

Verein für
Association pour le
Associazione per il



medizinische Qualitätskontrolle
contrôle de qualité médical
controllo di qualità medico

Commentaire de l'essai interlaboratoire

2016 - 4

Échantillons de l'essai interlaboratoire

L'homogénéité et la stabilité ont été vérifiées pour tous les échantillons avant respectivement pendant l'envoi et aucune anomalie n'a été constatée. Les tests de conformité ont été réalisés par les laboratoires de l'Hôpital Universitaire de Zürich (<http://www.uzl.usz.ch/>).

Ont été produits spécifiquement pour MQ en sous-traitance les échantillons d'essai interlaboratoire suivants:

B1 Strep A Test, B2 Uricult, H4 Hématologie parasitaire, K14 Marqueur tumoral

Détermination des valeurs-cible

Pour chaque valeur-cible est indiqué le mode de détermination utilisé selon les termes de la norme ISO17043:2010, B2.1 (Colonne "Type"):

- a Valeur connue, sur la base de la production.
- b Valeur de référence certifiée lors de l'utilisation d'échantillons spécifiques
- c Valeur de référence déterminée par analyse
- d „Consensus value“ des laboratoires d'experts
- e „Consensus value“ des participants

Pour les groupes de méthode incluant plus de 9 participants, les valeurs cibles sont déterminées comme étant la „Consensus value“ ("e") des participants. Pour la détermination de ces valeurs cibles est utilisée la moyenne réalisée par le groupe de méthodes. Les résultats qui présentent un écart par rapport à la valeur cible supérieur à 1.5 fois la tolérance Qualab, sont considérés comme résultats aberrants et exclus du calcul de la valeur de référence. Les résultats des essais d'aptitude sont utilisés comme valeur de base pour éliminer les taux aberrants. Afin de mettre à disposition de tous les participants des valeurs-cible les plus pertinentes possibles, d'autres procédures peuvent également être utilisées pour des groupes de méthode plus restreints.

Incertitude dans la détermination des valeurs-cible

L'incertitude-type (u_x) est calculée à l'aide de la formule suivante (ISO13528):

$$u_x = (\text{Valeur-cible}/100) * (1.25/\text{Racine carrée du "nombre des participants"}) * \text{CV en \%}$$

- u_x est exprimée dans la même unité que la valeur-cible
- u_x peut être comparée avec l'écart-type du collectif des participants ($\text{Ecart-type} = \text{Valeur-cible} * \text{CV en \%} / 100$)
- Pour un nombre de participants >18, l'incertitude-type (u_x) est significativement plus petite que la dispersion du collectif des participants et peut donc être négligée.


Tolérances QUALAB et MQ

Pour les analyses obligatoires sont utilisées les tolérances fixées par Qualab (www.qualab.ch, contrôle de qualité externe). Pour les analyses non-obligatoires, les tolérances sont fixées par le directeur de MQ pilotant l'essai interlaboratoire.

Si l'incertitude déterminée de la valeur de référence u_x est supérieure à 15% de la tolérance QUALAB ou de MQ, la lettre qui caractérise le type de détermination de la valeur-cible est en outre marquée d'une étoile (par exemple "e*"). Nous rendons ainsi les participants attentifs au fait que l'incertitude de la valeur de référence peut avoir une influence sur l'évaluation.

Représentation graphique

La représentation graphique des résultats est la suivante:

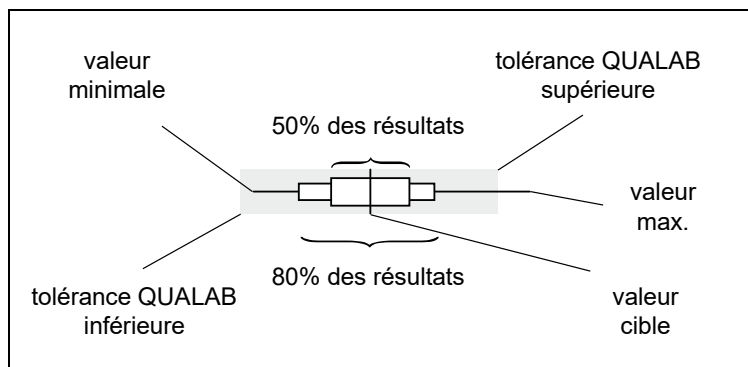


Comparaison des appareils

Les données de ce rapport vous permettent de comparer les performances respectives des divers appareils. Toutefois, vous devez tenir compte des points suivants:

- Le contrôle Chimie K1 est un sérum de contrôle commercialisé prêt à l'emploi. Même si l'échantillon est d'origine humaine, des effets matriciels sont possibles. Ceux-ci dépendent de l'appareil et peuvent générer des valeurs cible différentes.
- Seul un échantillon a été mesuré. La dispersion des résultats étant dépendante de la nature de l'échantillon (effets matriciels) et du niveau du résultat, les coefficients de variation déterminés (CV en %) ne sont pas toujours valables.
- Une grande partie des taux aberrants est due à des erreurs administratives (erreur d'unité, confusion des résultats) ou à des erreurs de manipulation (erreur d'échantillon, dissolution incorrecte, mélange insuffisant) et n'a rien à voir avec le type d'appareil.


Zürich, 3.12.2016



Dr. R. Fried
Directeur de l'essai interlaboratoire

Il n'est pas autorisé de publier une partie ou l'intégralité de ce rapport sans notre accord écrit préalable. L'original est conservé dans les archives sous www.mqzh.ch.

Hémoglobine

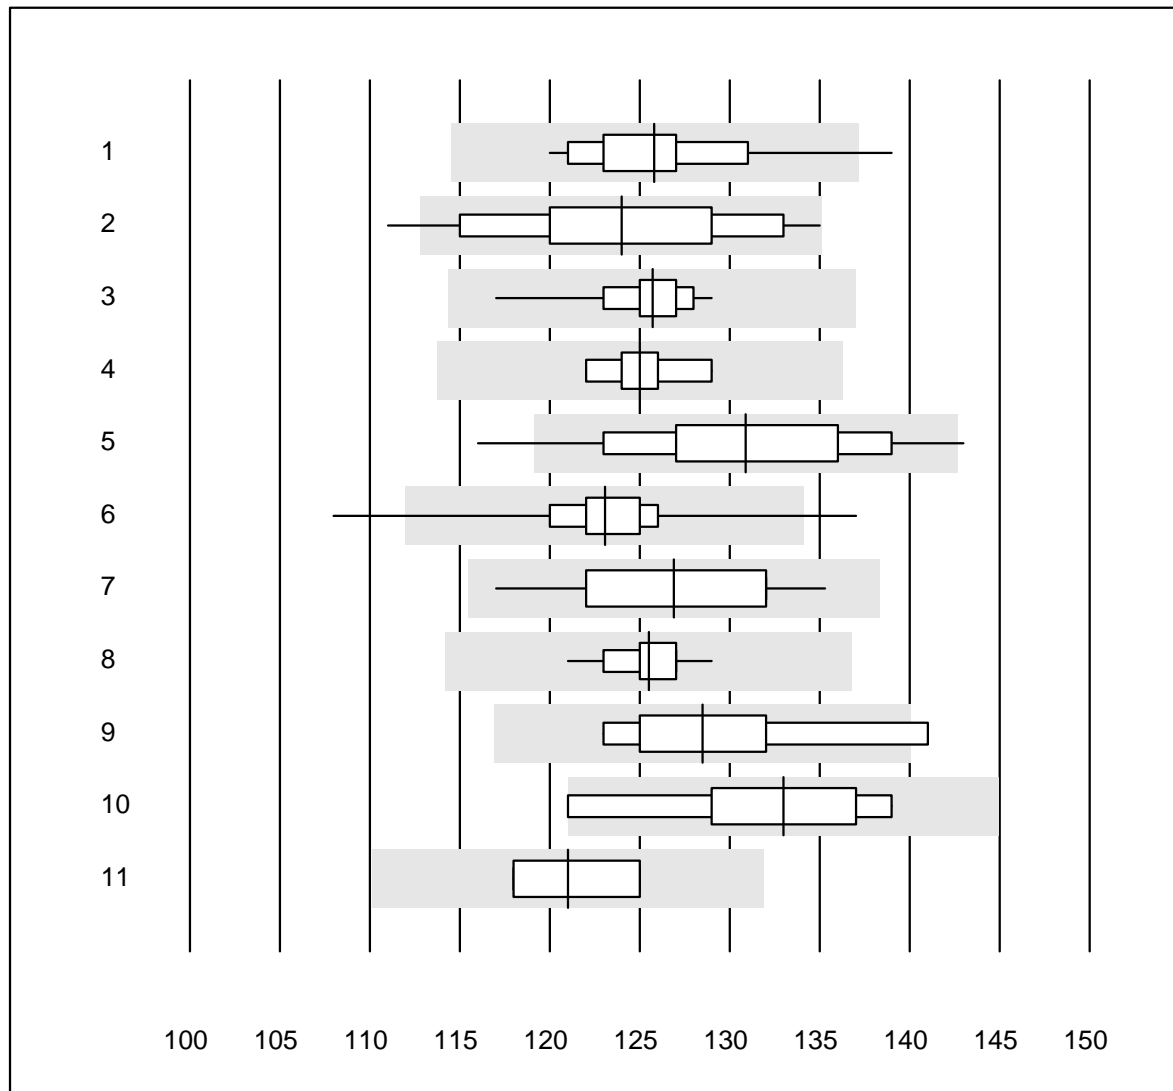


Tolérance QUALAB : 9 %

Hémoglobine (g/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Automate	33	90.9	3.0	6.1	125.8	3.4	e
2	Cyanmethémoglobine	41	90.3	2.4	7.3	124.0	5.0	e
3	Sysmex X	38	97.4	0.0	2.6	125.7	1.7	e
4	ABX Pentra	9	100.0	0.0	0.0	125.0	1.8	e
5	Reflotron	63	87.4	6.3	6.3	130.9	4.8	e
6	Hemocue	356	92.4	1.4	6.2	123.1	2.4	e
7	Dr. Lange	19	78.9	0.0	21.1	126.9	4.0	e
8	Hemocontrol	13	100.0	0.0	0.0	125.5	1.7	e
9	Eurolyser	6	83.3	16.7	0.0	128.5	4.9	e*
10	DiaSpect	8	87.5	12.5	0.0	133.0	4.6	e*
11	MS4	4	75.0	0.0	25.0	121.0	3.1	e*

Hémoglobine

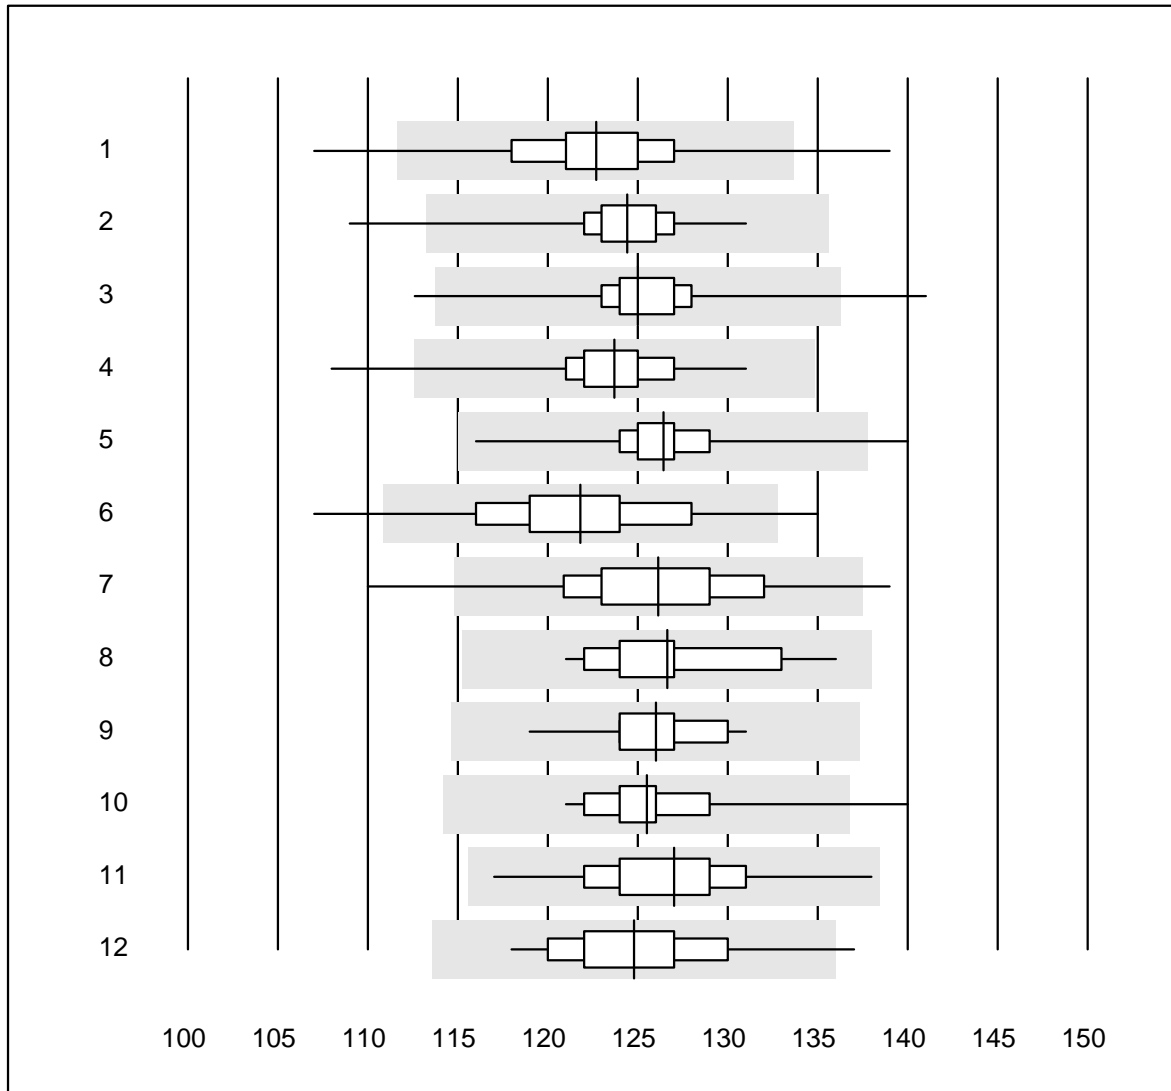


Tolérance QUALAB : 9 %

Hémoglobine (g/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Abx Micros	692	94.4	1.6	4.0	122.7	3.2	e
2	Microsemi	403	96.3	0.5	3.2	124.4	2.0	e
3	Sysmex KX21	378	95.0	1.3	3.7	125.0	2.2	e
4	Sysmex PochH - 100i	209	97.2	1.4	1.4	123.7	2.5	e
5	Sysmex XP 300	299	96.3	0.7	3.0	126.4	1.9	e
6	Mythic	245	94.3	2.4	3.3	121.8	3.6	e
7	Swelab	70	91.4	5.7	2.9	126.1	4.0	e
8	Abacus Junior	12	91.7	0.0	8.3	126.6	3.5	e
9	Medonic	14	100.0	0.0	0.0	126.0	2.3	e
10	Nihon Kohden Celltac	41	90.3	2.4	7.3	125.5	2.6	e
11	Samsung HC10	45	100.0	0.0	0.0	127.0	3.3	e
12	Norma Icon 3	24	95.8	4.2	0.0	124.8	3.3	e

Hématocrite

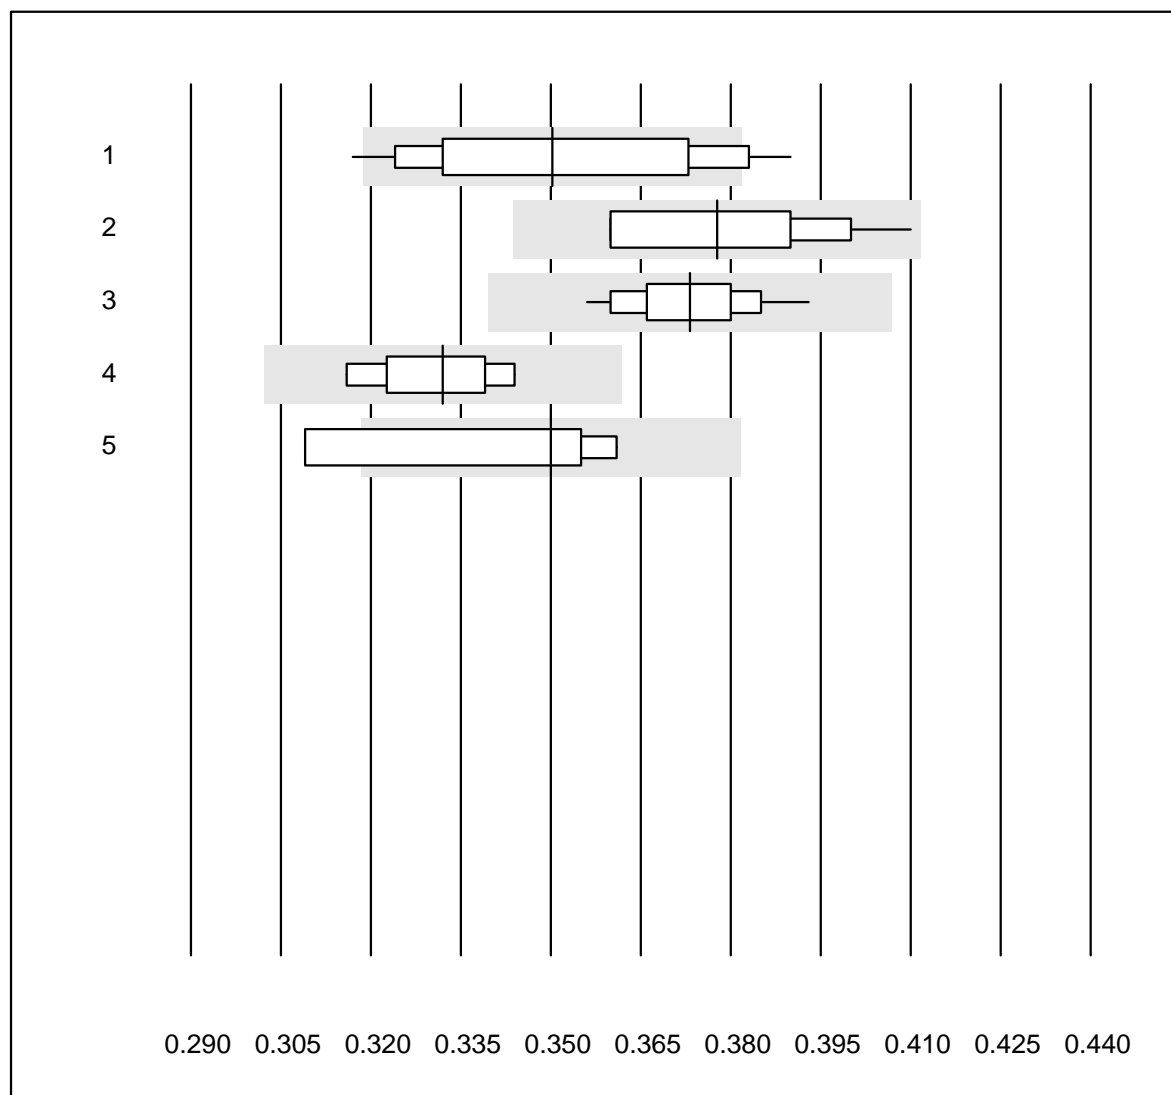


Tolérance QUALAB : 9 %

Hématocrite (l/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Automate	28	78.6	14.3	7.1	0.35	6.1	e*
2	Centrifuge	13	100.0	0.0	0.0	0.38	5.1	e*
3	Sysmex X	37	97.3	0.0	2.7	0.37	2.4	e
4	ABX Pentra	9	100.0	0.0	0.0	0.33	3.0	e
5	MS4	4	75.0	25.0	0.0	0.35	6.8	e*

Hématocrite

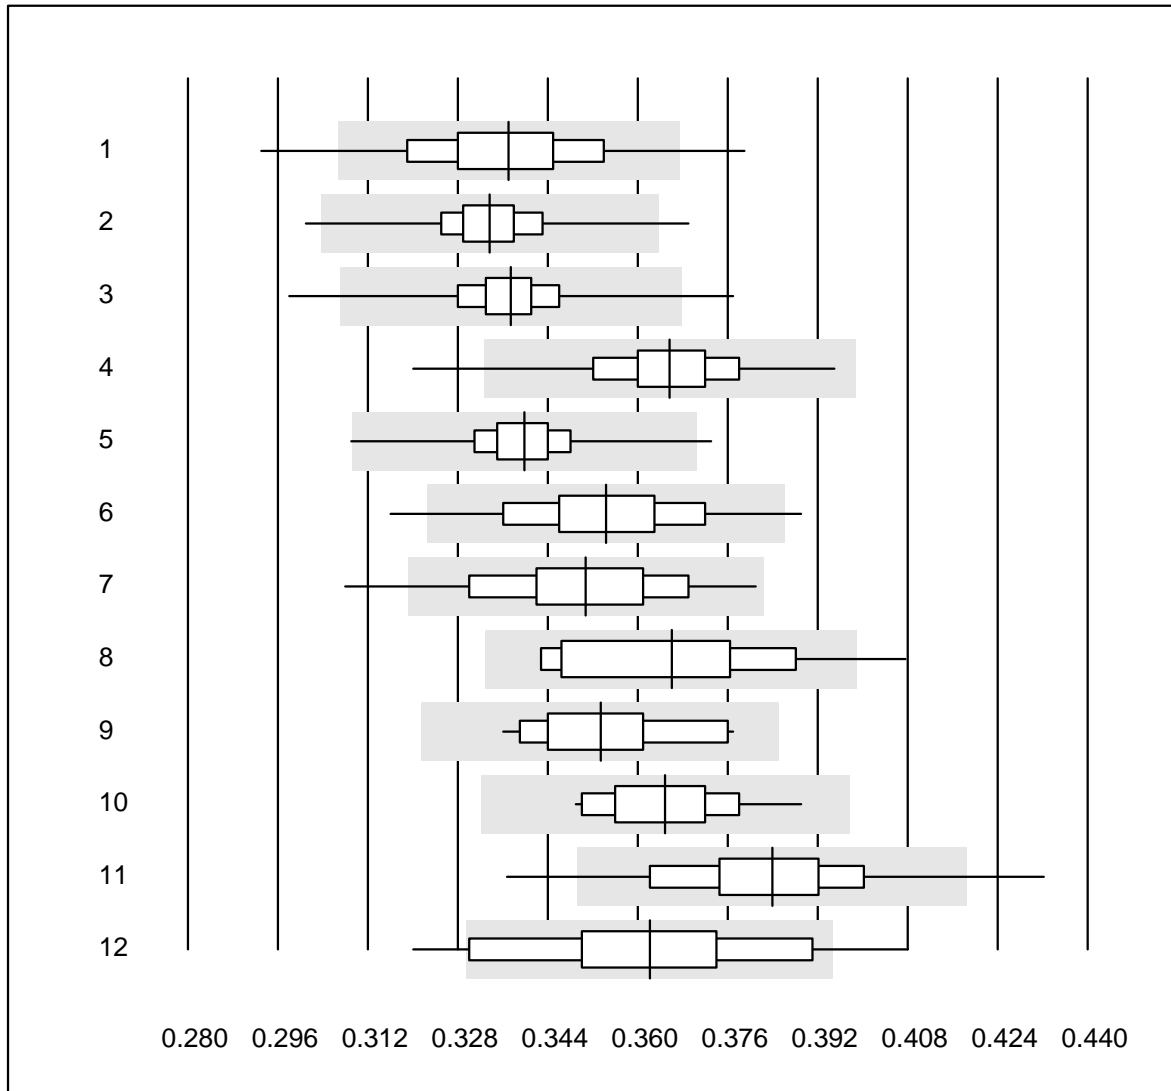


Tolérance QUALAB : 9 %

Hématocrite (l/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Abx Micros	692	90.3	3.5	6.2	0.34	4.2	e
2	Microsemi	400	97.5	0.5	2.0	0.33	2.3	e
3	Sysmex KX21	378	95.0	1.3	3.7	0.34	2.5	e
4	Sysmex PochH - 100i	209	97.2	1.4	1.4	0.37	3.1	e
5	Sysmex XP 300	295	97.3	1.0	1.7	0.34	2.3	e
6	Mythic	245	93.4	3.3	3.3	0.35	3.9	e
7	Swelab	70	90.0	4.3	5.7	0.35	4.5	e
8	Abacus Junior	12	75.0	8.3	16.7	0.37	5.8	e*
9	Medonic	14	92.9	0.0	7.1	0.35	3.7	e
10	Nihon Kohden Celltac	41	92.7	0.0	7.3	0.36	2.7	e
11	Samsung HC10	45	91.2	4.4	4.4	0.38	4.1	e
12	Norma Icon 3	24	70.8	16.7	12.5	0.36	6.6	e*

Erythrocytes

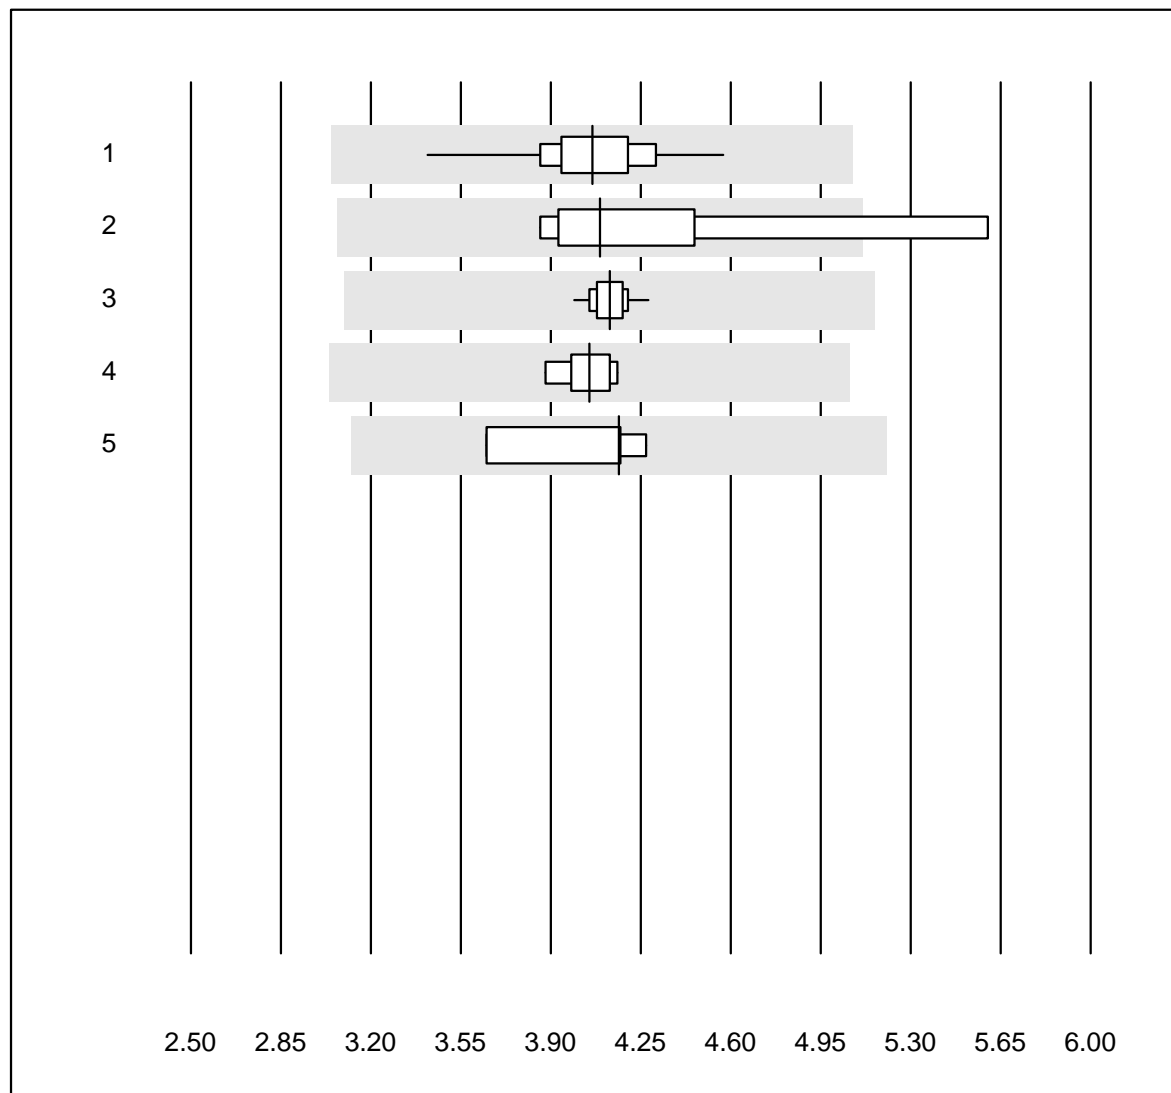


Tolérance QUALAB : 25 %

Erythrocytes (T/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Automate	27	96.3	0.0	3.7	4.06	5.4	e
2	Microscopie	7	85.7	14.3	0.0	4.09	14.0	e*
3	Sysmex X	39	94.9	0.0	5.1	4.13	1.7	e
4	ABX Pentra	9	100.0	0.0	0.0	4.05	2.5	e
5	MS4	4	100.0	0.0	0.0	4.17	6.9	e*

Erythrocytes

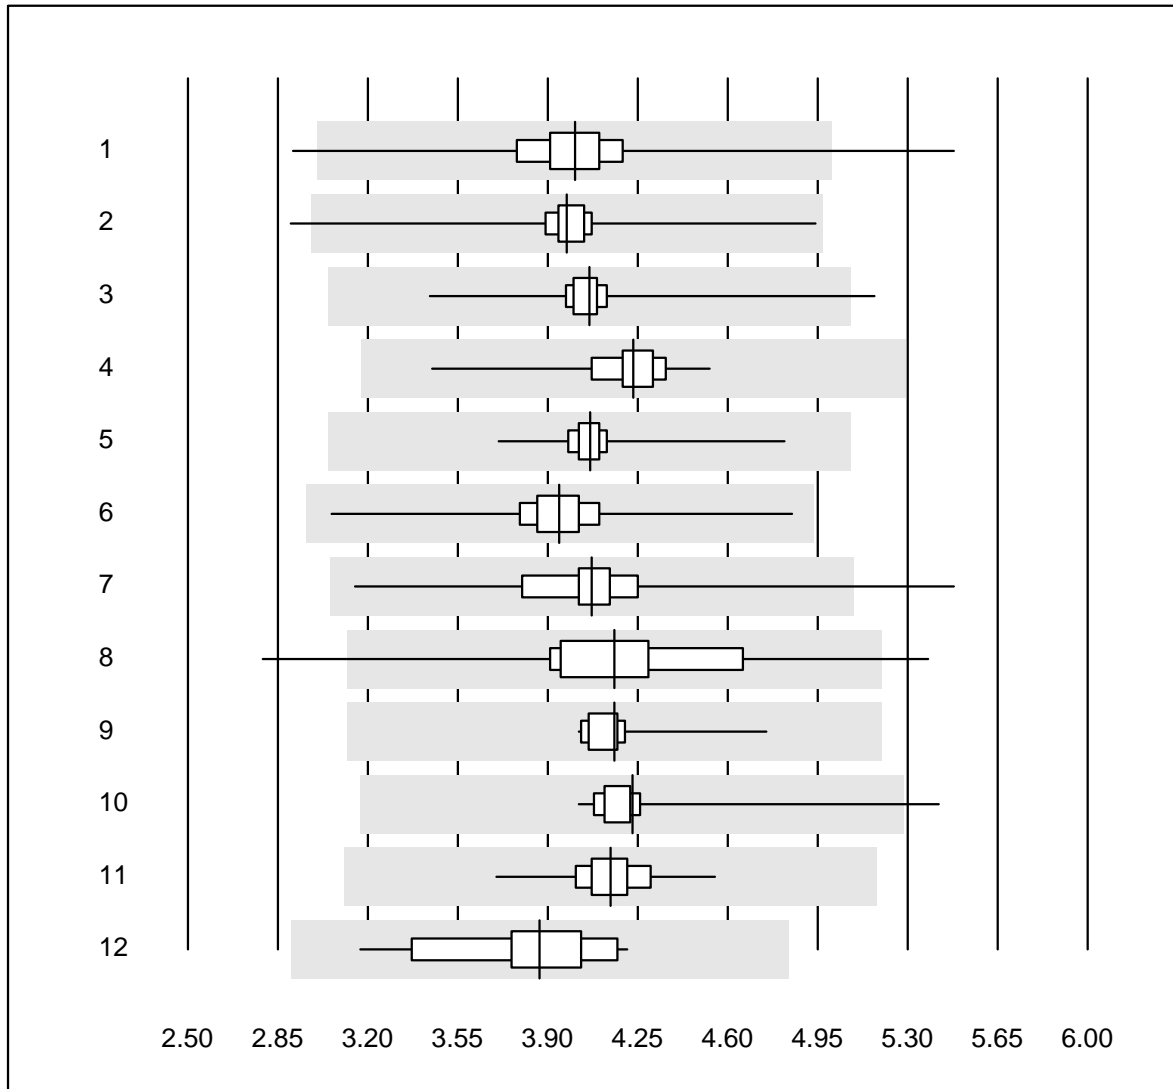


Tolérance QUALAB : 25 %

Erythrocytes (T/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Abx Micros	691	96.5	0.9	2.6	4.00	5.7	e
2	Microsemi	402	98.1	0.2	1.7	3.97	3.4	e
3	Sysmex KX21	378	97.6	0.8	1.6	4.06	3.6	e
4	Sysmex PochH - 100i	210	99.0	0.0	1.0	4.23	3.1	e
5	Sysmex XP 300	296	98.6	0.0	1.4	4.06	2.6	e
6	Mythic	245	98.4	0.0	1.6	3.94	3.9	e
7	Swelab	70	98.6	1.4	0.0	4.07	6.6	e
8	Abacus Junior	12	83.3	16.7	0.0	4.16	14.2	e*
9	Medonic	14	100.0	0.0	0.0	4.16	4.3	e
10	Nihon Kohden Celltac	41	97.6	2.4	0.0	4.23	6.1	e
11	Samsung HC10	45	100.0	0.0	0.0	4.14	3.2	e
12	Norma Icon 3	24	100.0	0.0	0.0	3.87	7.0	e

Leucocytes

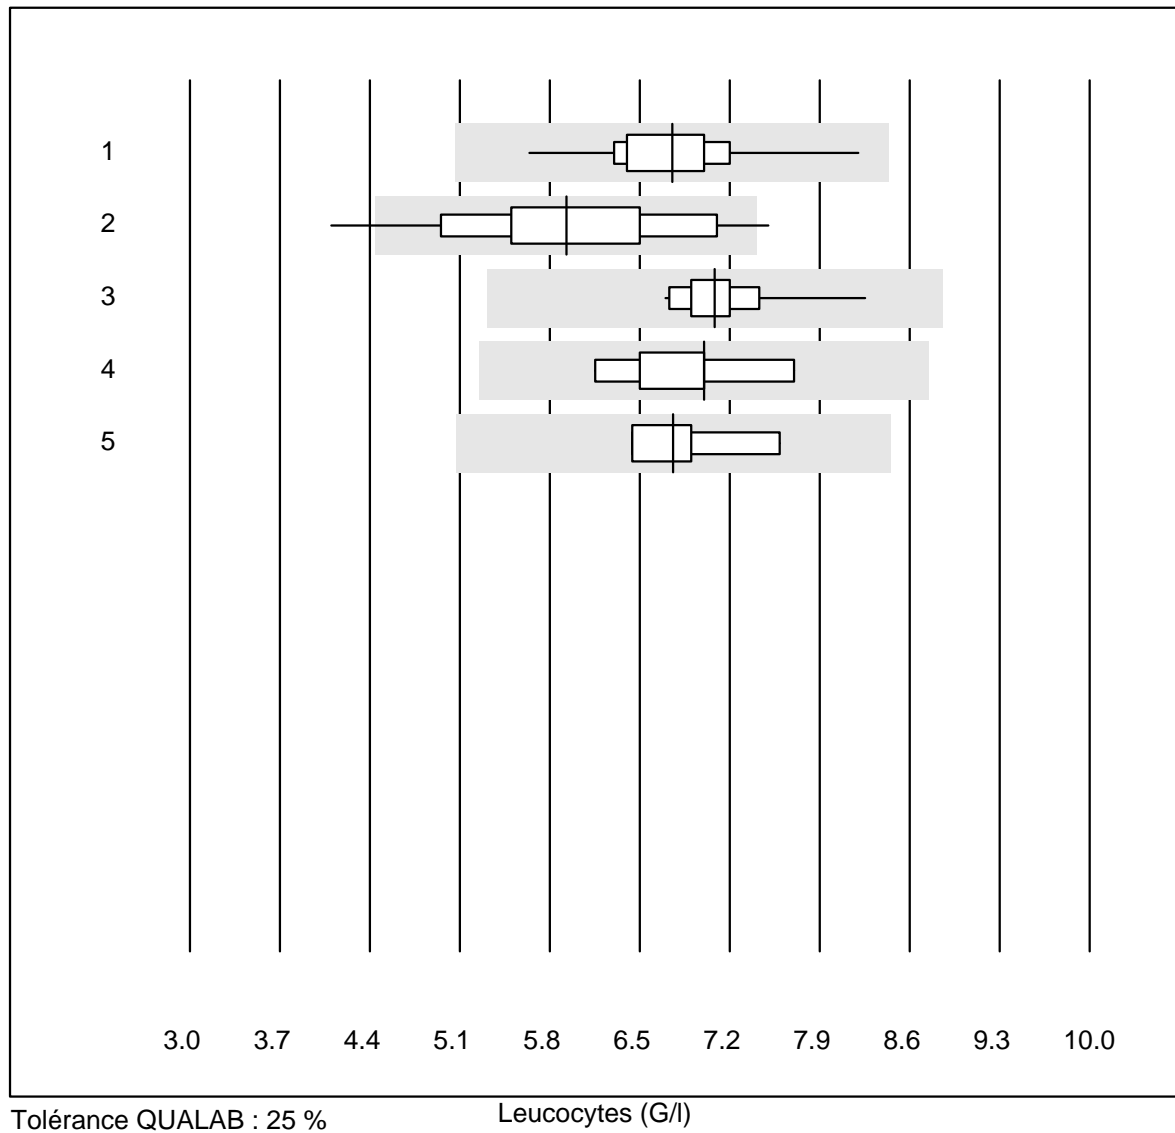

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Automate	25	96.0	0.0	4.0	6.75	8.0	e
2 Microscopie	47	87.2	8.5	4.3	5.93	13.5	e
3 Sysmex X	39	100.0	0.0	0.0	7.08	4.1	e
4 ABX Pentra	9	100.0	0.0	0.0	7.00	6.9	e
5 MS4	4	100.0	0.0	0.0	6.76	7.3	e*

Leucocytes

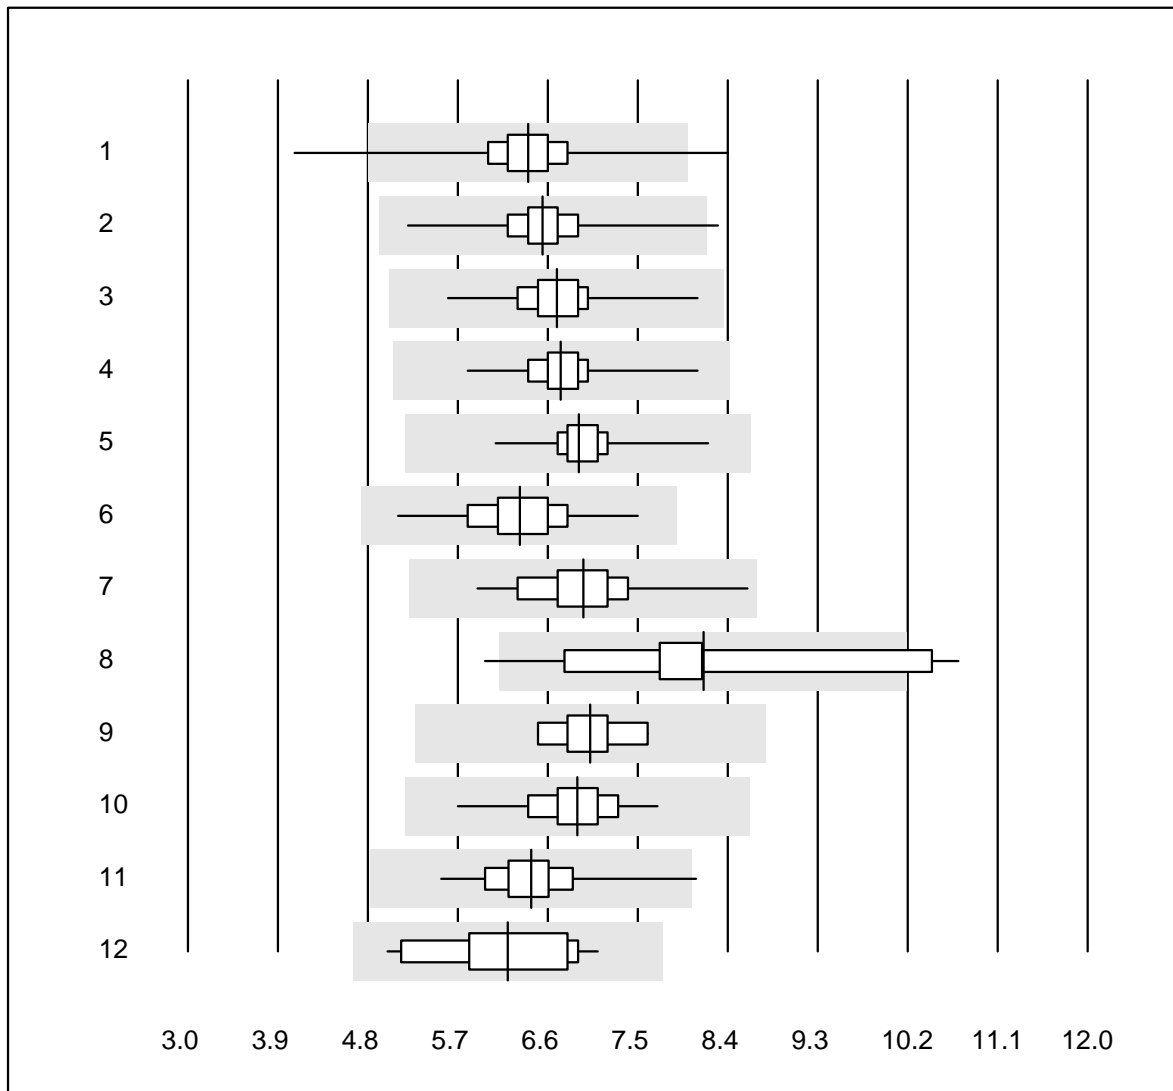


Tolérance QUALAB : 25 %

Leucocytes (G/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Abx Micros	692	97.4	0.7	1.9	6.40	5.9	e
2	Microsemi	403	99.8	0.2	0.0	6.55	4.6	e
3	Sysmex KX21	378	99.2	0.0	0.8	6.69	4.6	e
4	Sysmex PochH - 100i	210	99.5	0.0	0.5	6.73	4.4	e
5	Sysmex XP 300	297	99.0	0.0	1.0	6.91	3.4	e
6	Mythic	243	99.6	0.0	0.4	6.32	6.1	e
7	Swelab	70	100.0	0.0	0.0	6.96	6.9	e
8	Abacus Junior	12	75.0	25.0	0.0	8.16	16.1	e*
9	Medonic	14	100.0	0.0	0.0	7.02	5.2	e
10	Nihon Kohden Celltac	41	100.0	0.0	0.0	6.89	5.5	e
11	Samsung HC10	45	97.8	2.2	0.0	6.43	6.1	e
12	Norma Icon 3	24	95.8	0.0	4.2	6.20	9.9	e

Thrombocytes

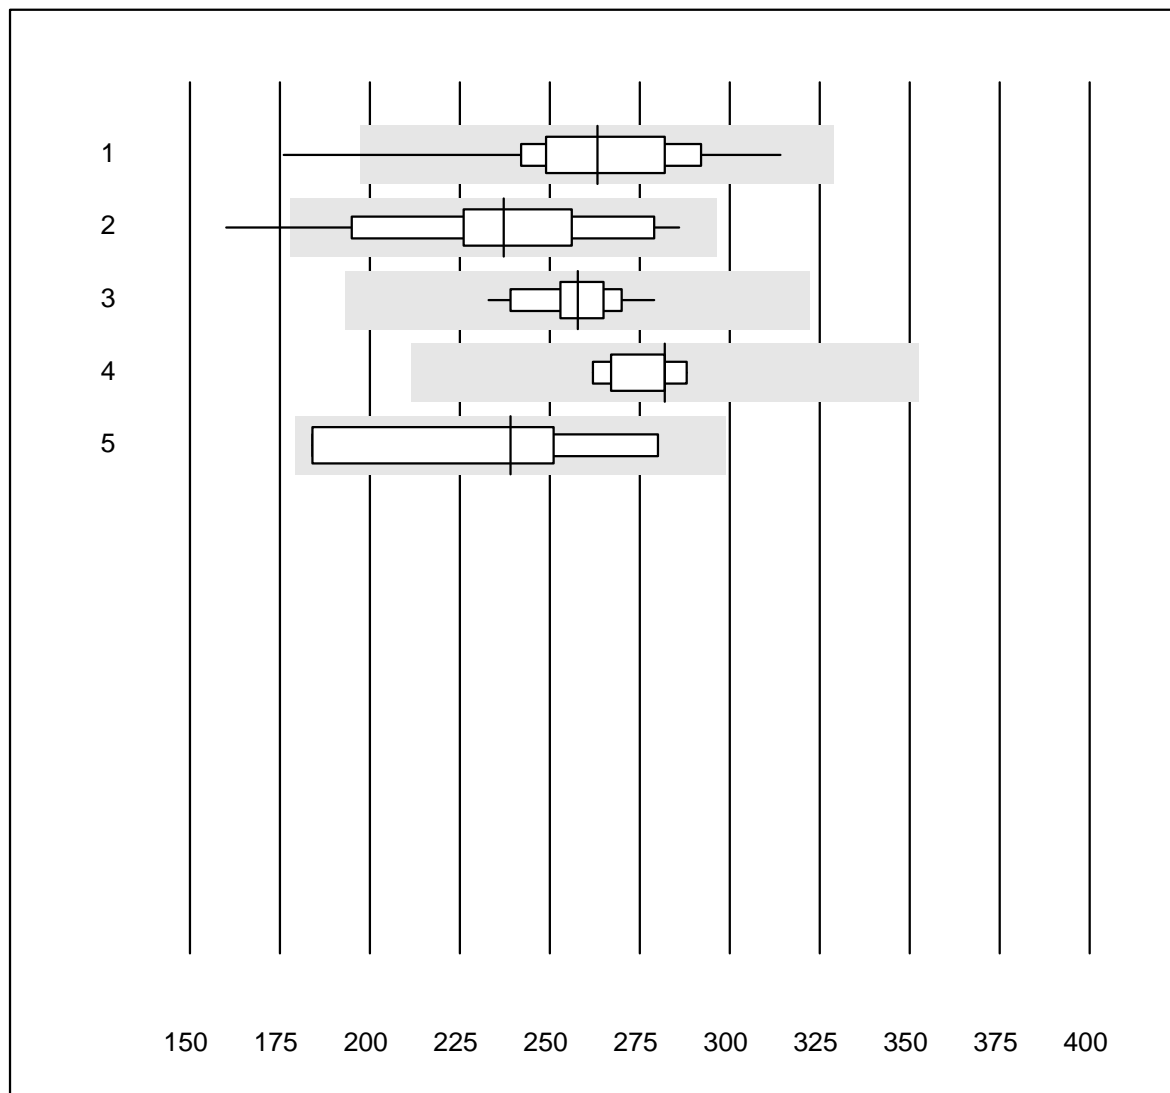


Tolérance QUALAB : 25 %

Thrombocytes (G/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Automate	23	95.7	4.3	0.0	263.2	10.9	e
2	Microscopie	27	81.5	7.4	11.1	237.2	13.6	e
3	Sysmex X	38	100.0	0.0	0.0	257.8	4.1	e
4	ABX Pentra	9	100.0	0.0	0.0	282.0	3.6	e
5	MS4	4	100.0	0.0	0.0	239.0	17.2	e*

Thrombocytes

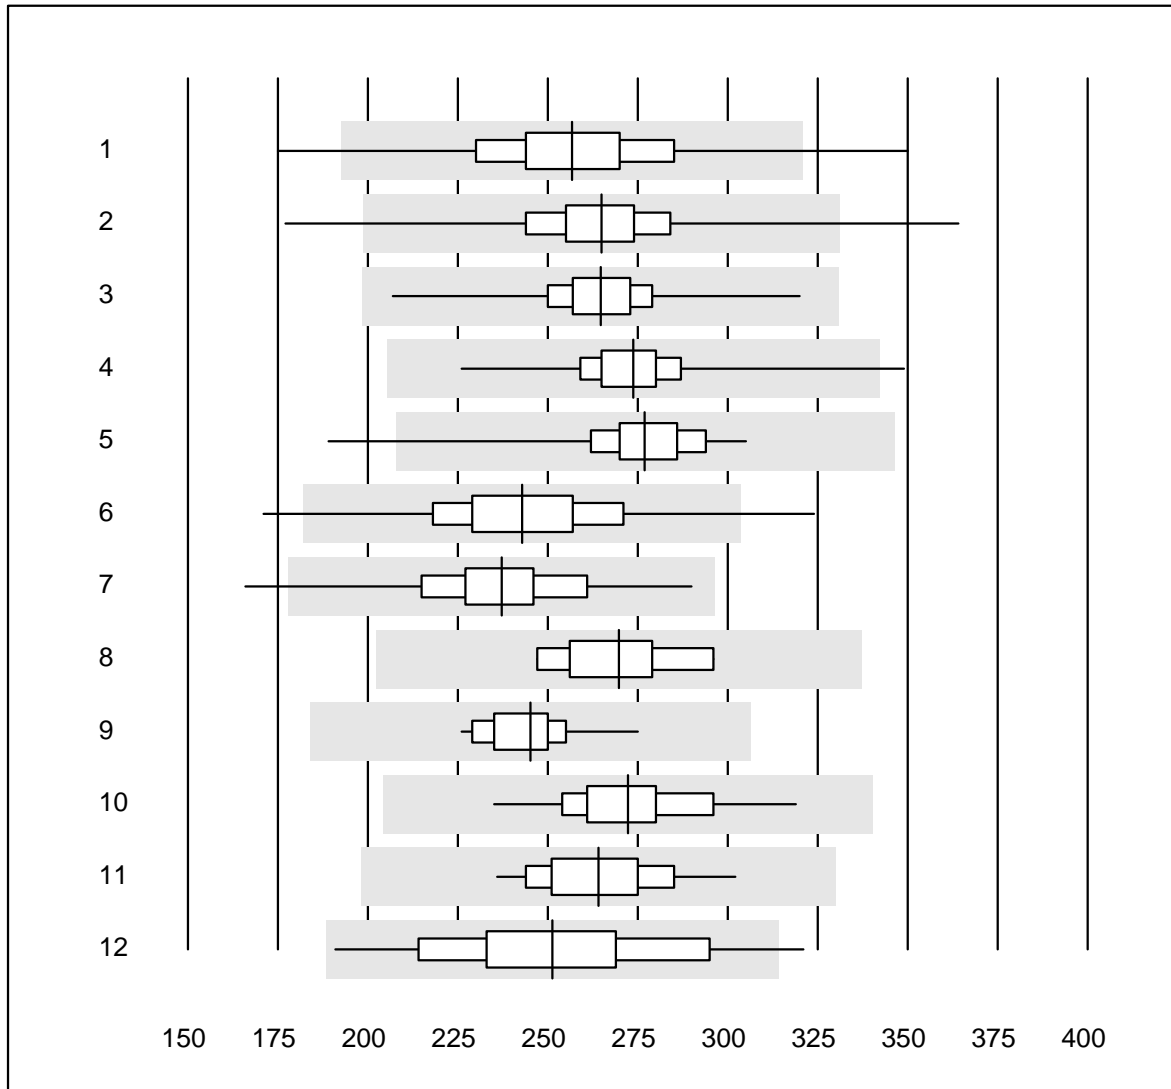


Tolérance QUALAB : 25 %

Thrombocytes (G/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Abx Micros	692	96.1	2.2	1.7	256.7	9.2	e
2	Microsemi	403	98.5	1.5	0.0	264.9	7.1	e
3	Sysmex KX21	378	99.7	0.0	0.3	264.6	5.1	e
4	Sysmex PochH - 100i	209	99.0	0.5	0.5	273.7	5.1	e
5	Sysmex XP 300	297	99.0	0.3	0.7	277.0	5.0	e
6	Mythic	245	97.6	1.6	0.8	242.9	9.0	e
7	Swelab	70	98.6	1.4	0.0	237.2	8.4	e
8	Abacus Junior	12	75.0	0.0	25.0	269.7	6.5	e
9	Medonic	14	100.0	0.0	0.0	245.1	5.1	e
10	Nihon Kohden Celltac	41	100.0	0.0	0.0	272.3	6.3	e
11	Samsung HC10	45	100.0	0.0	0.0	264.1	6.2	e
12	Norma Icon 3	24	95.8	4.2	0.0	251.3	12.7	e

CRP

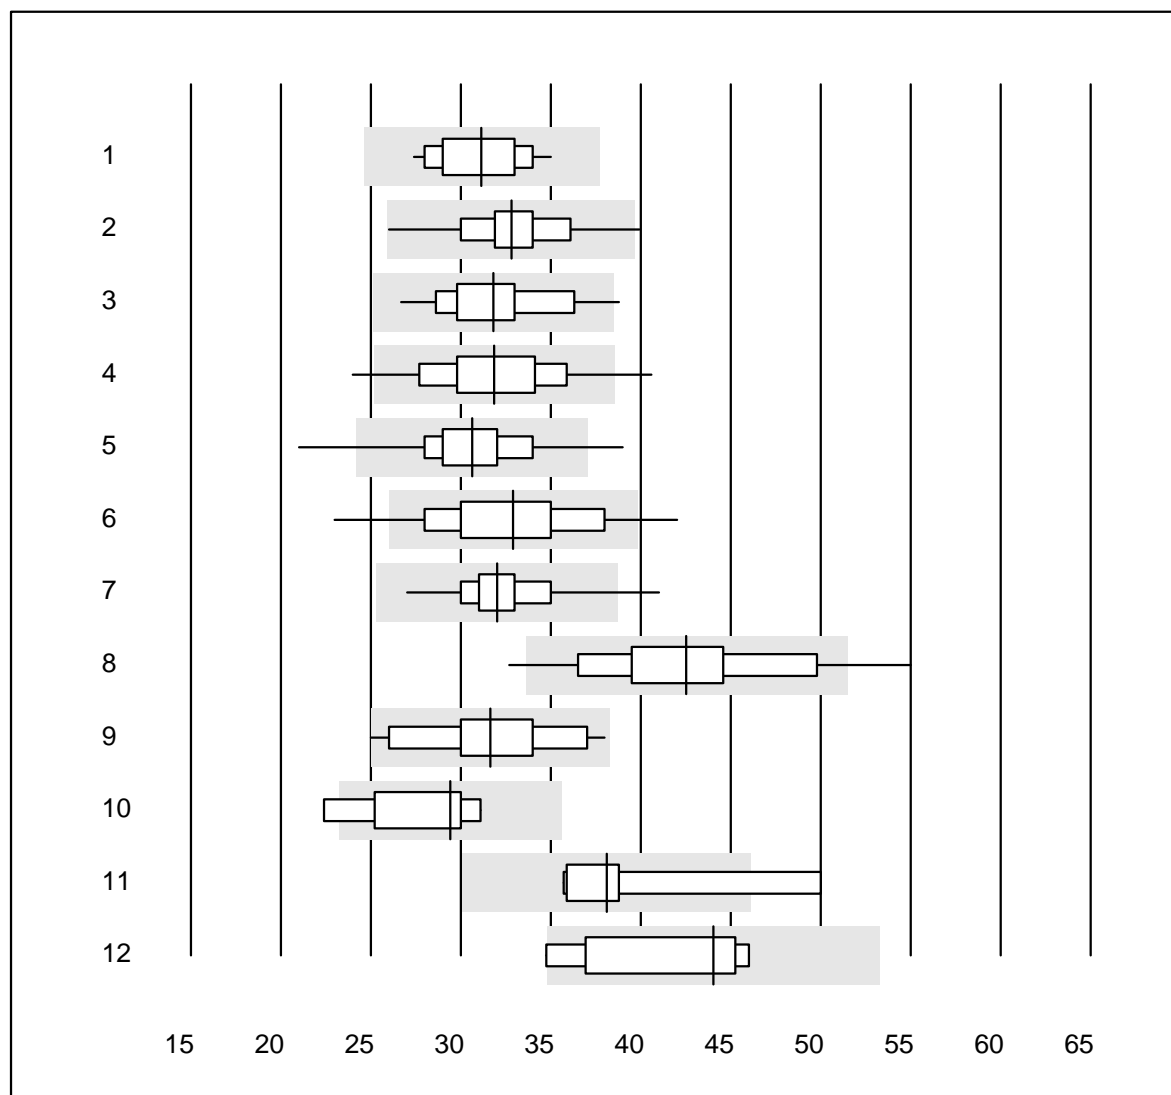


Tolérance QUALAB : 21 %

CRP (mg/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas	14	100.0	0.0	0.0	31.2	7.5	e
2	Turbidimetrie	33	84.9	3.0	12.1	32.8	8.2	e
3	Abx Micros	78	96.1	1.3	2.6	31.8	9.3	e
4	ABX Micros CRP200	275	94.5	3.3	2.2	31.8	10.2	e
5	Afinion	1291	98.8	1.0	0.2	30.6	7.6	e
6	NycoCard SingleTest-	321	79.1	7.8	13.1	32.9	11.1	e
7	Quick Read go	159	96.3	0.6	3.1	32.0	6.3	e
8	Eurolyser	131	75.5	6.9	17.6	42.5	11.2	e
9	Fuji Dri-Chem	27	100.0	0.0	0.0	31.6	11.0	e
10	Autolyser/DiaSys	9	77.8	11.1	11.1	29.4	10.5	e*
11	Piccolo	6	83.3	16.7	0.0	38.1	13.6	e*
12	AFIAS	5	80.0	20.0	0.0	44.0	12.5	e*

CRP

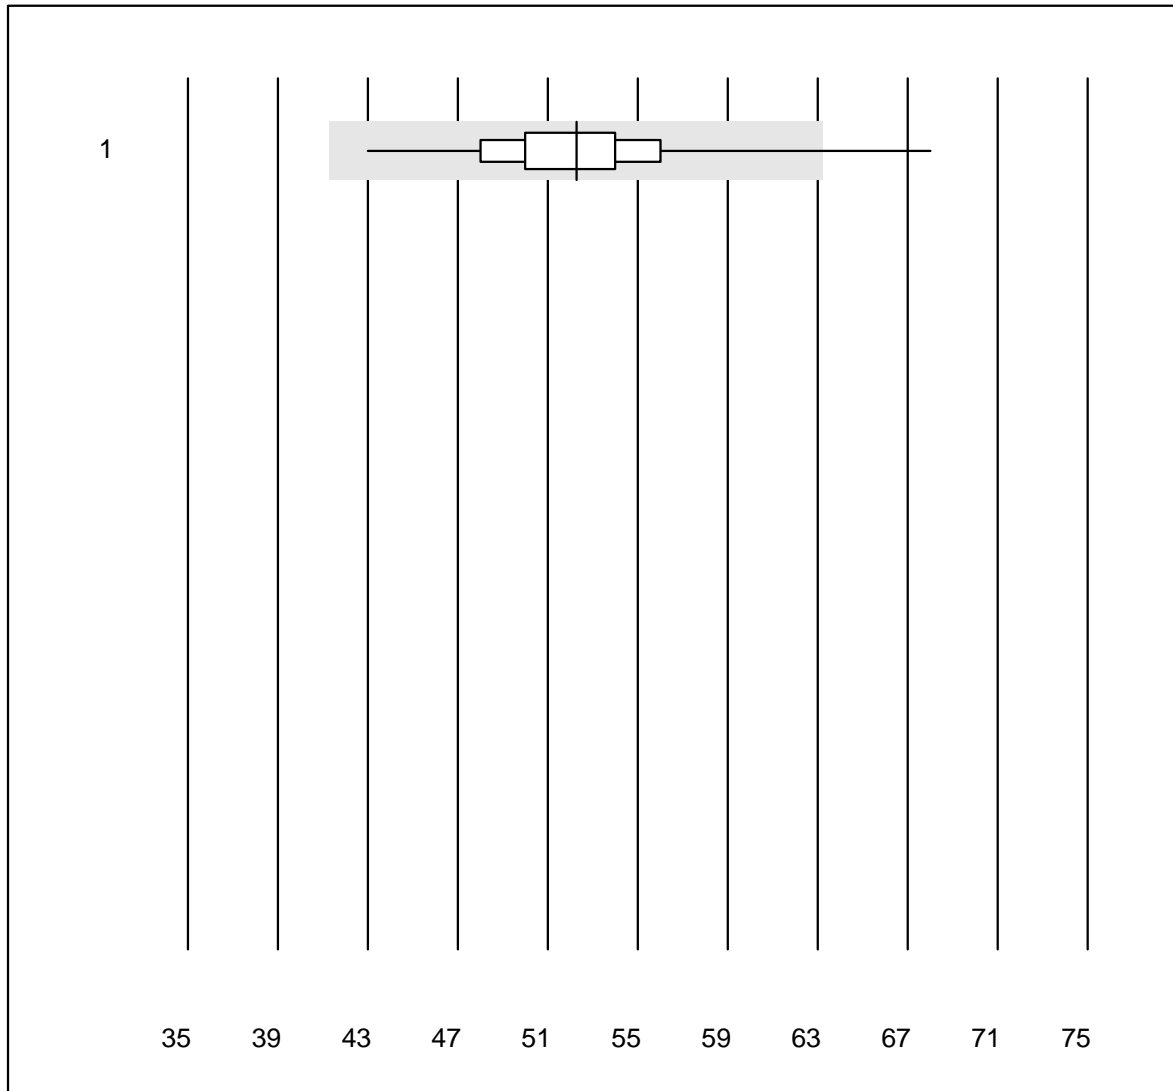


Tolérance QUALAB : 21 %

CRP (mg/l)


No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 QuickRead (sang comp	132	97.7	0.8	1.5	52.3	6.3	e

CRP

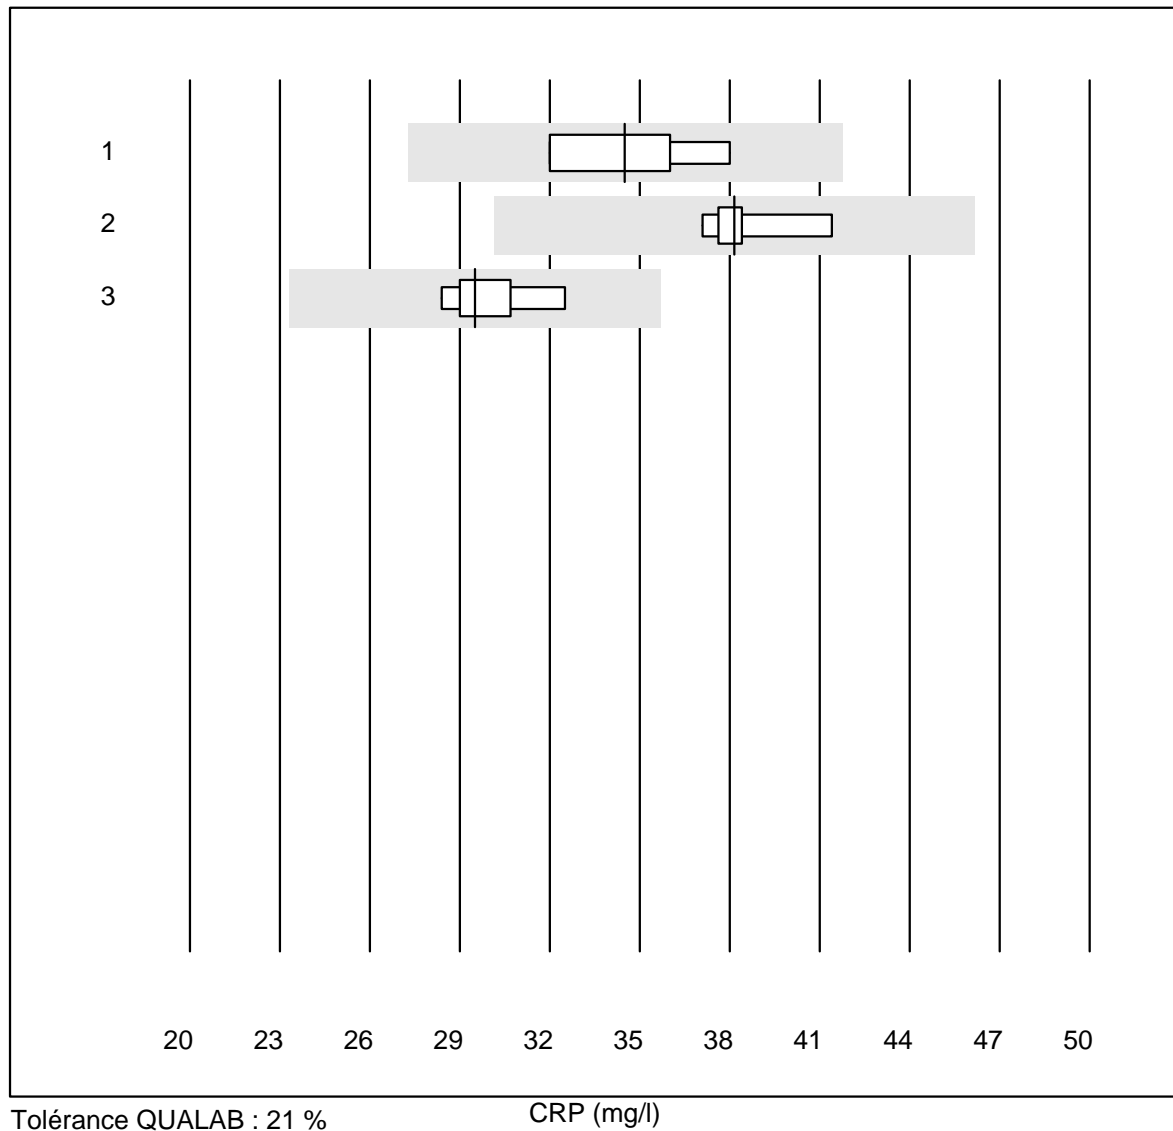


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 AQT 90 FLEX	8	100.0	0.0	0.0	34.5	6.5	e
2 Spotchem D-Concept	5	100.0	0.0	0.0	38.2	4.4	e
3 Spotchem SI-3510	5	100.0	0.0	0.0	29.5	5.4	e

CRP

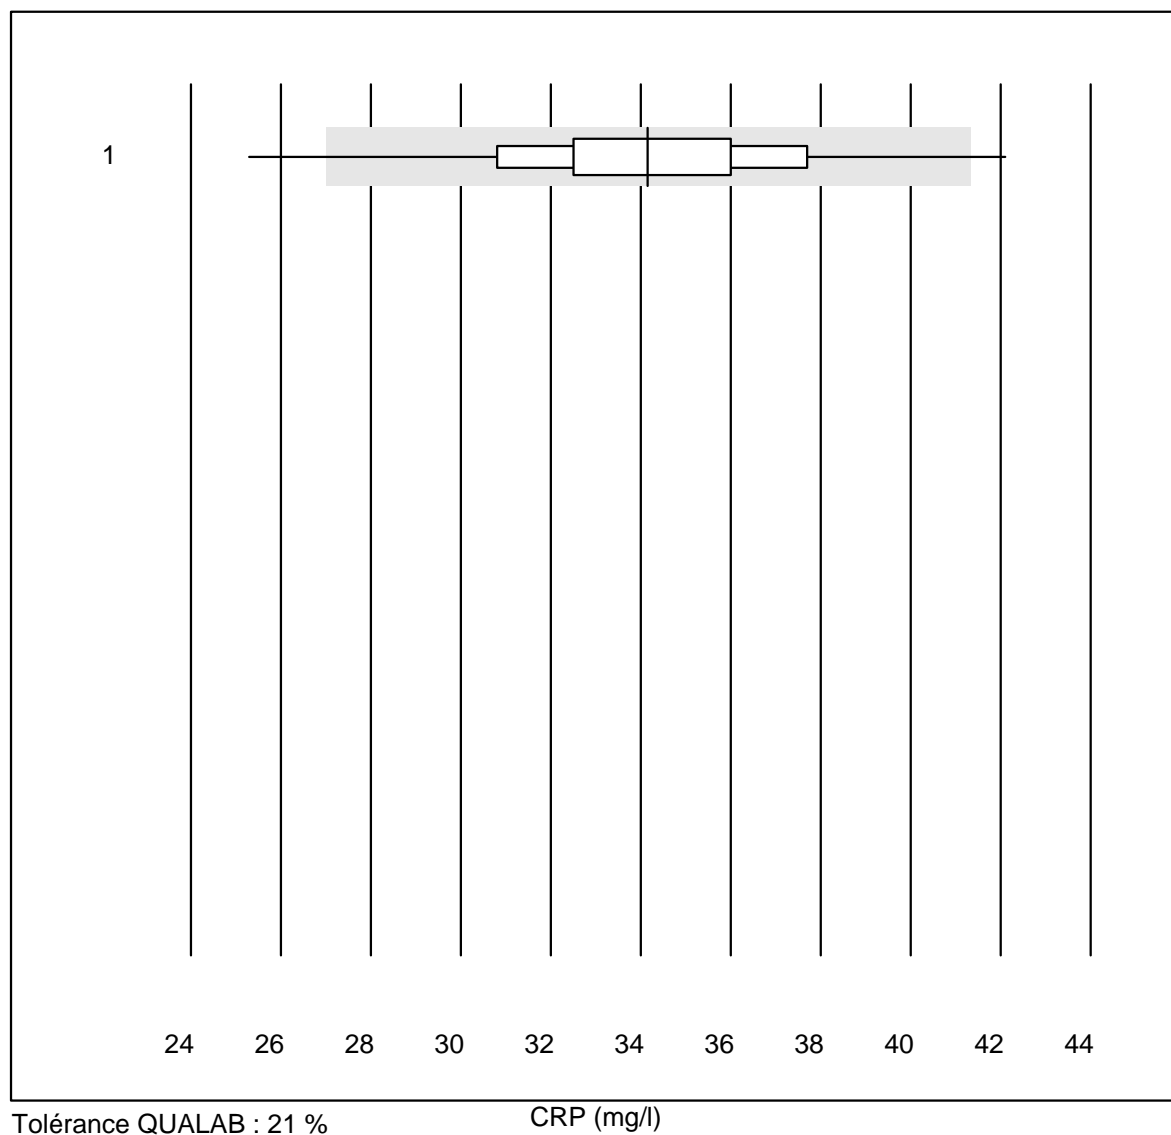

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Microsemi	395	97.9	1.3	0.8	34.2	7.8	e

IgG

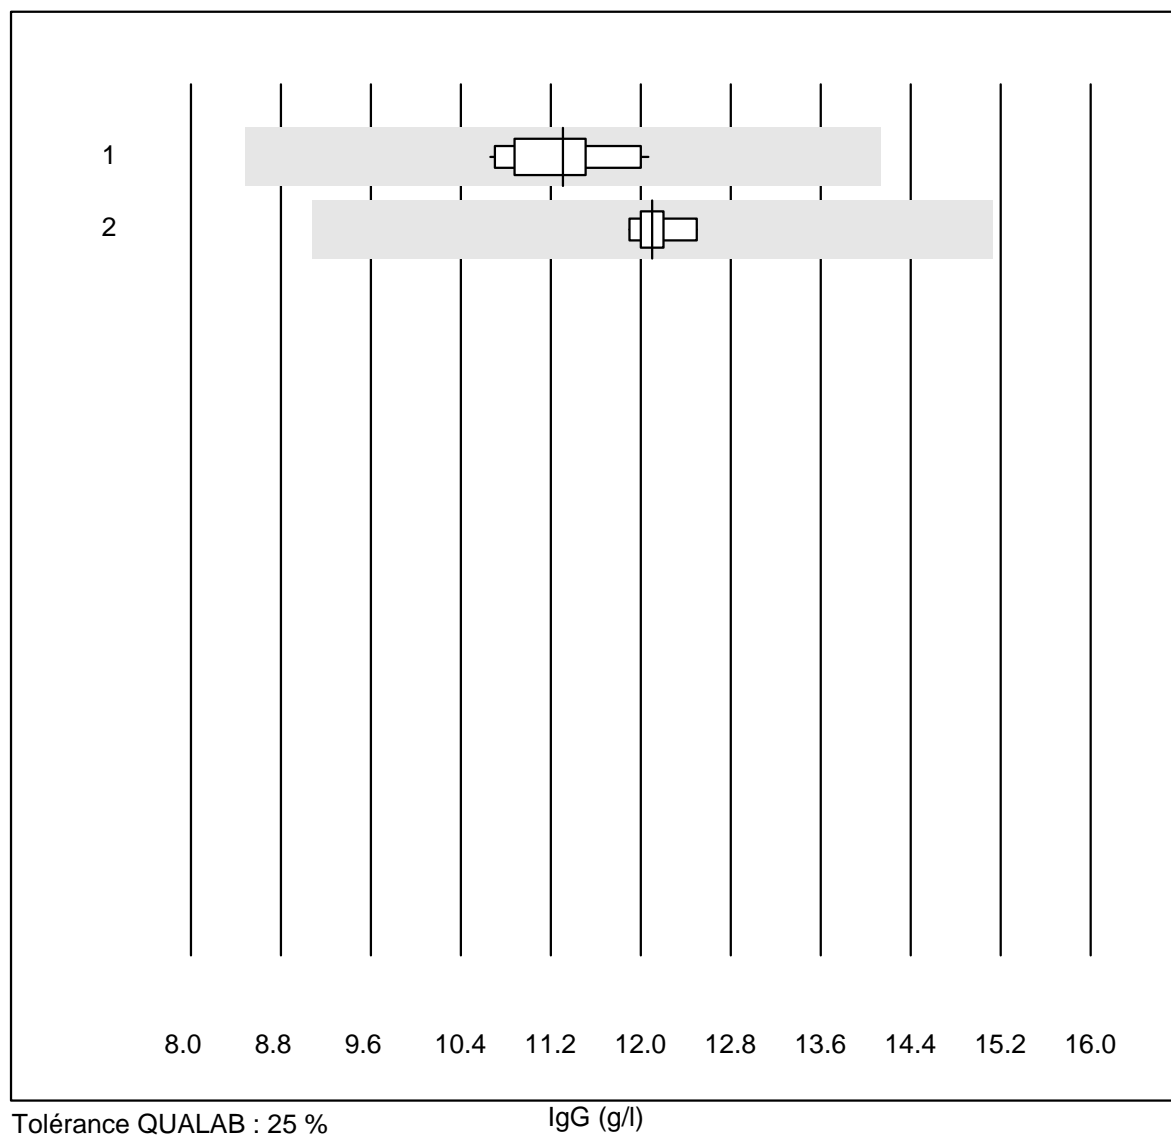


Tolérance QUALAB : 25 %

IgG (g/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Turbidimétrie	12	100.0	0.0	0.0	11.3	4.2	e
2 Néphélométrie	7	85.7	0.0	14.3	12.1	1.7	e

IgA

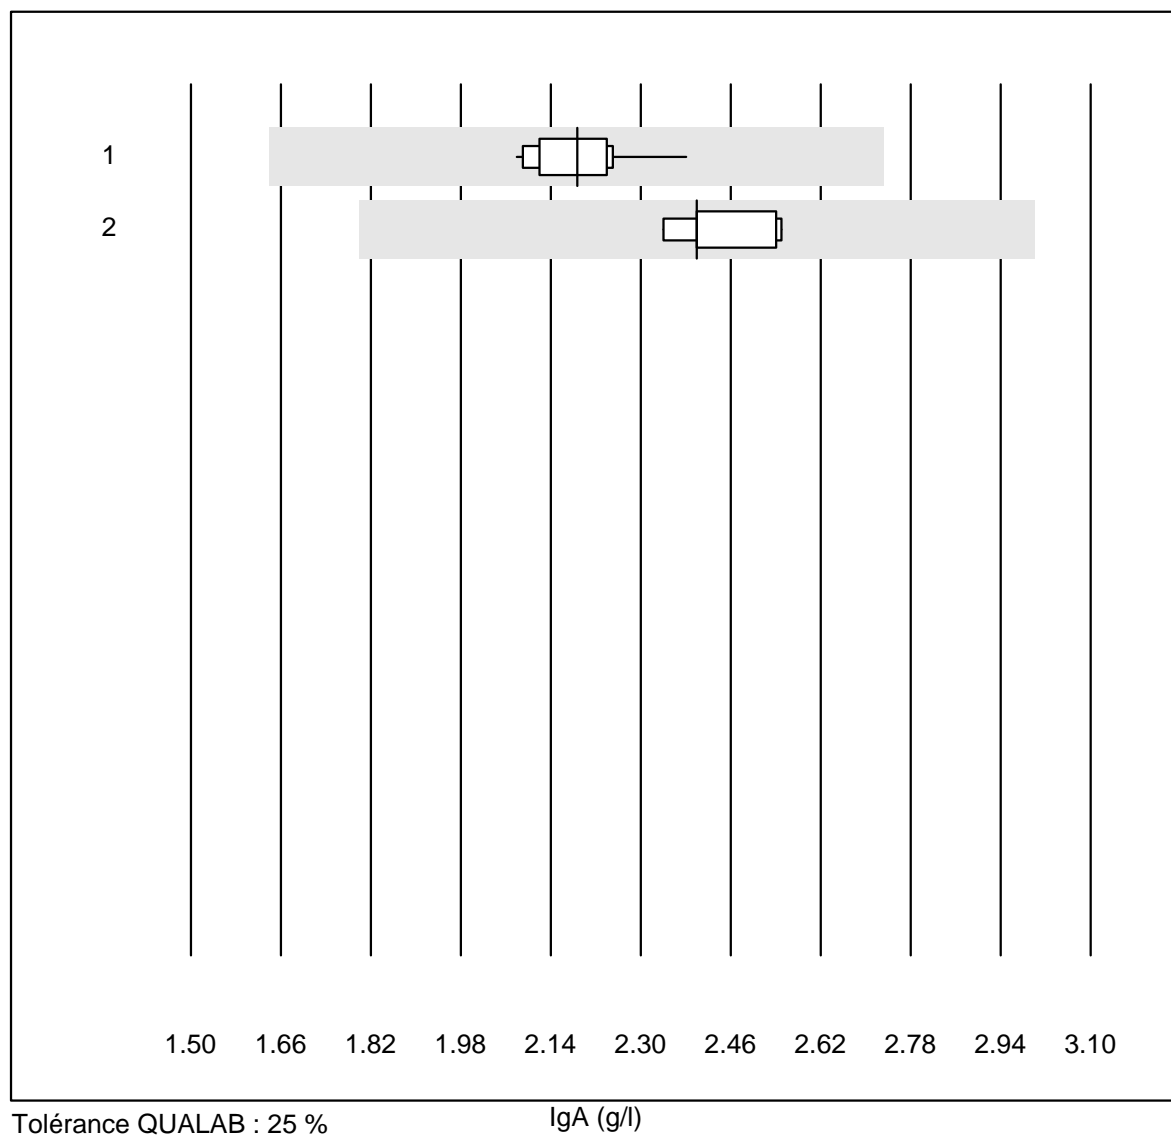

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Turbidimétrie	11	100.0	0.0	0.0	2.2	4.0	e
2 Néphélométrie	7	85.7	0.0	14.3	2.4	3.5	e

IgM

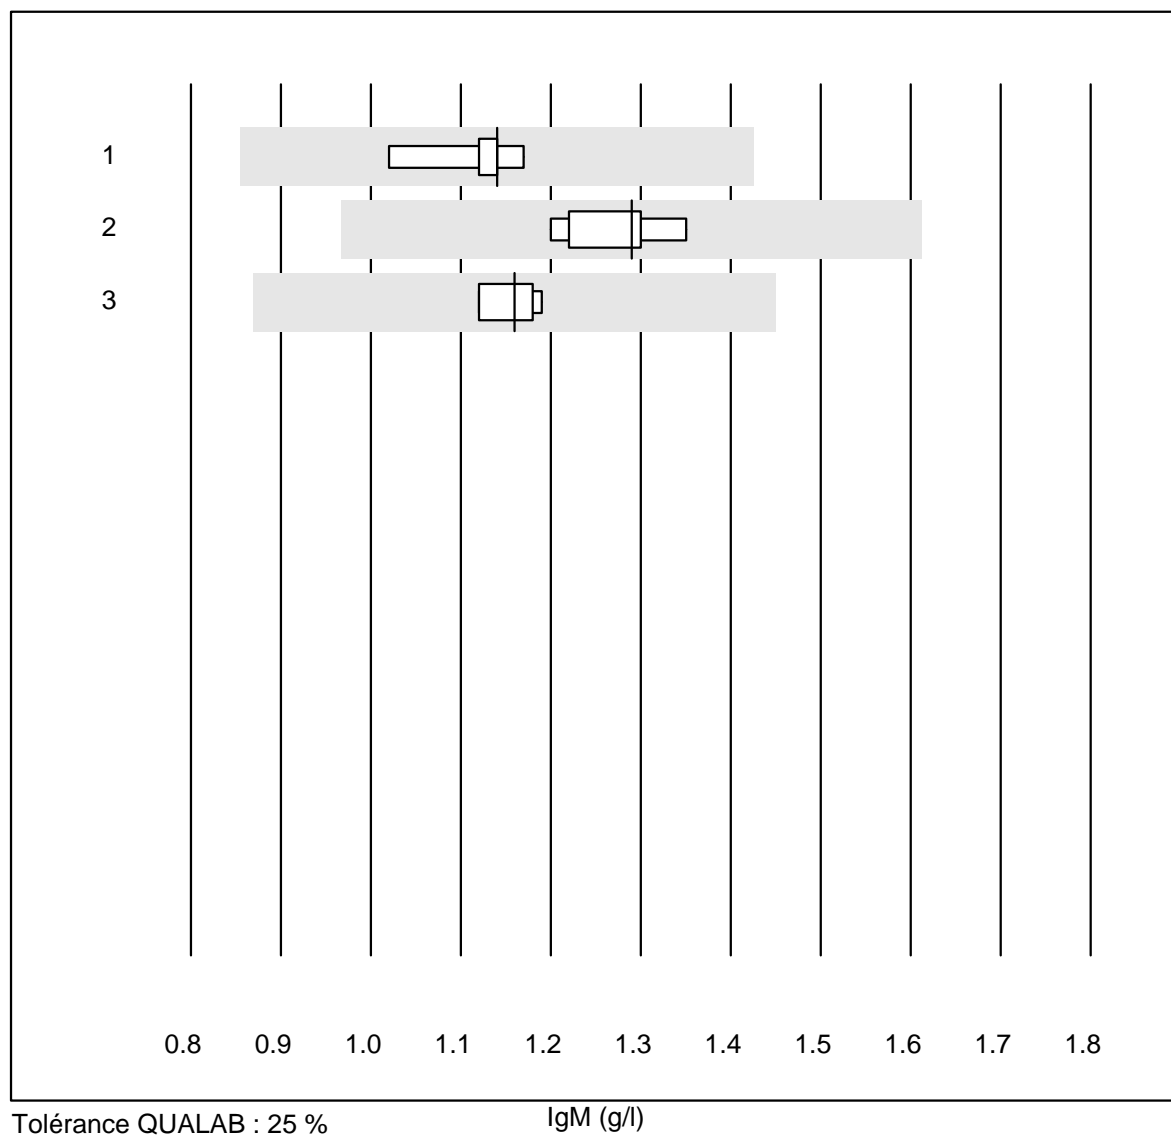


Tolérance QUALAB : 25 %

IgM (g/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Turbidimetrie	7	100.0	0.0	0.0	1.1	4.3	e
2	Nephelometrie	7	71.4	0.0	28.6	1.3	4.8	e
3	Cobas Integra 800/40	5	100.0	0.0	0.0	1.2	2.8	e

IgE

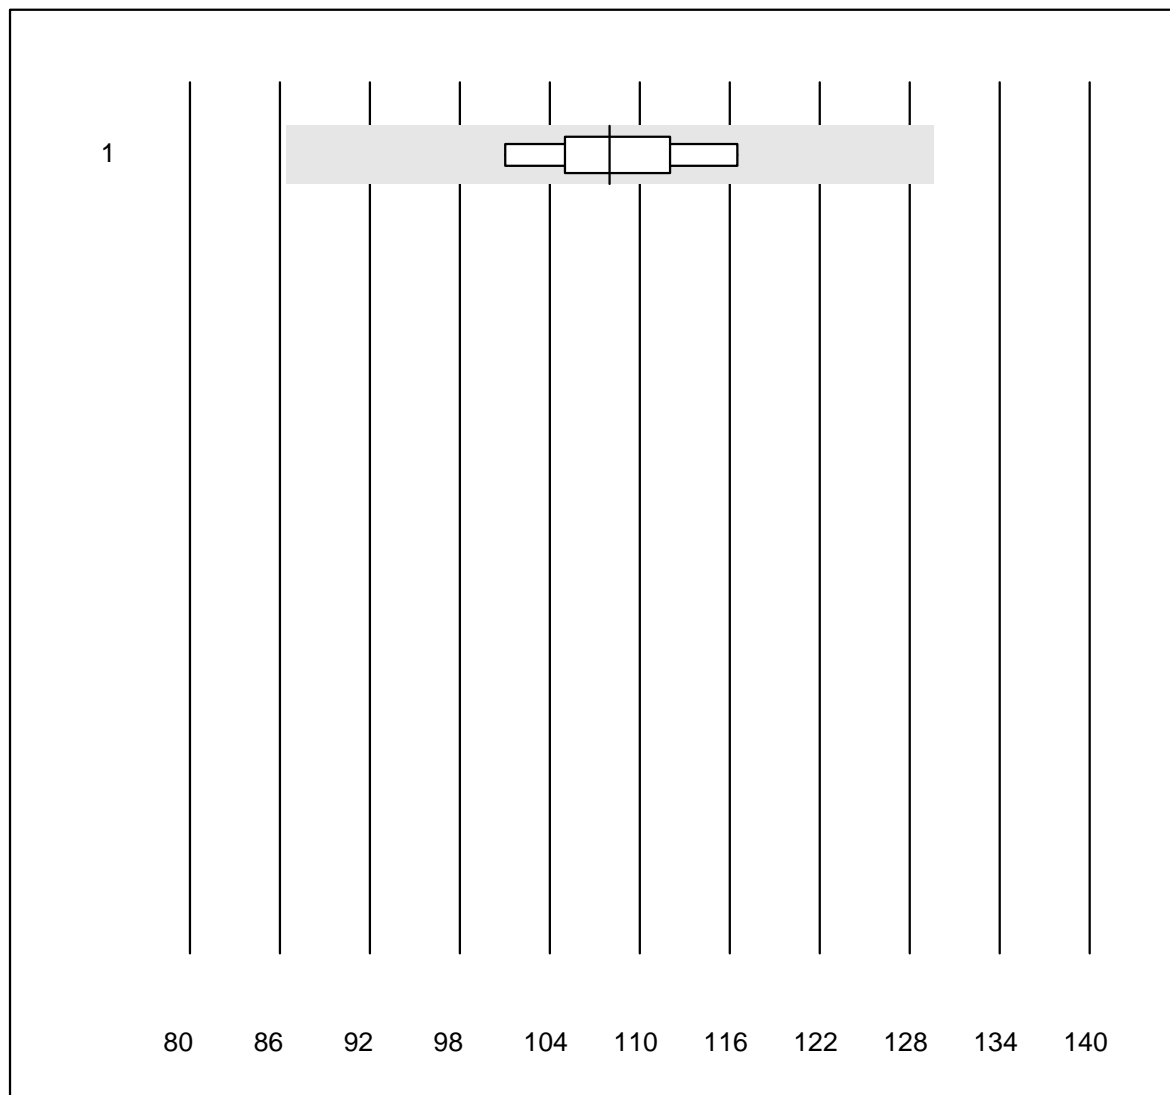


Tolérance QUALAB : 20 %

IgE (kU/L)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	9	100.0	0.0	0.0	108	5.0	e

Alpha-1-Antitrypsine

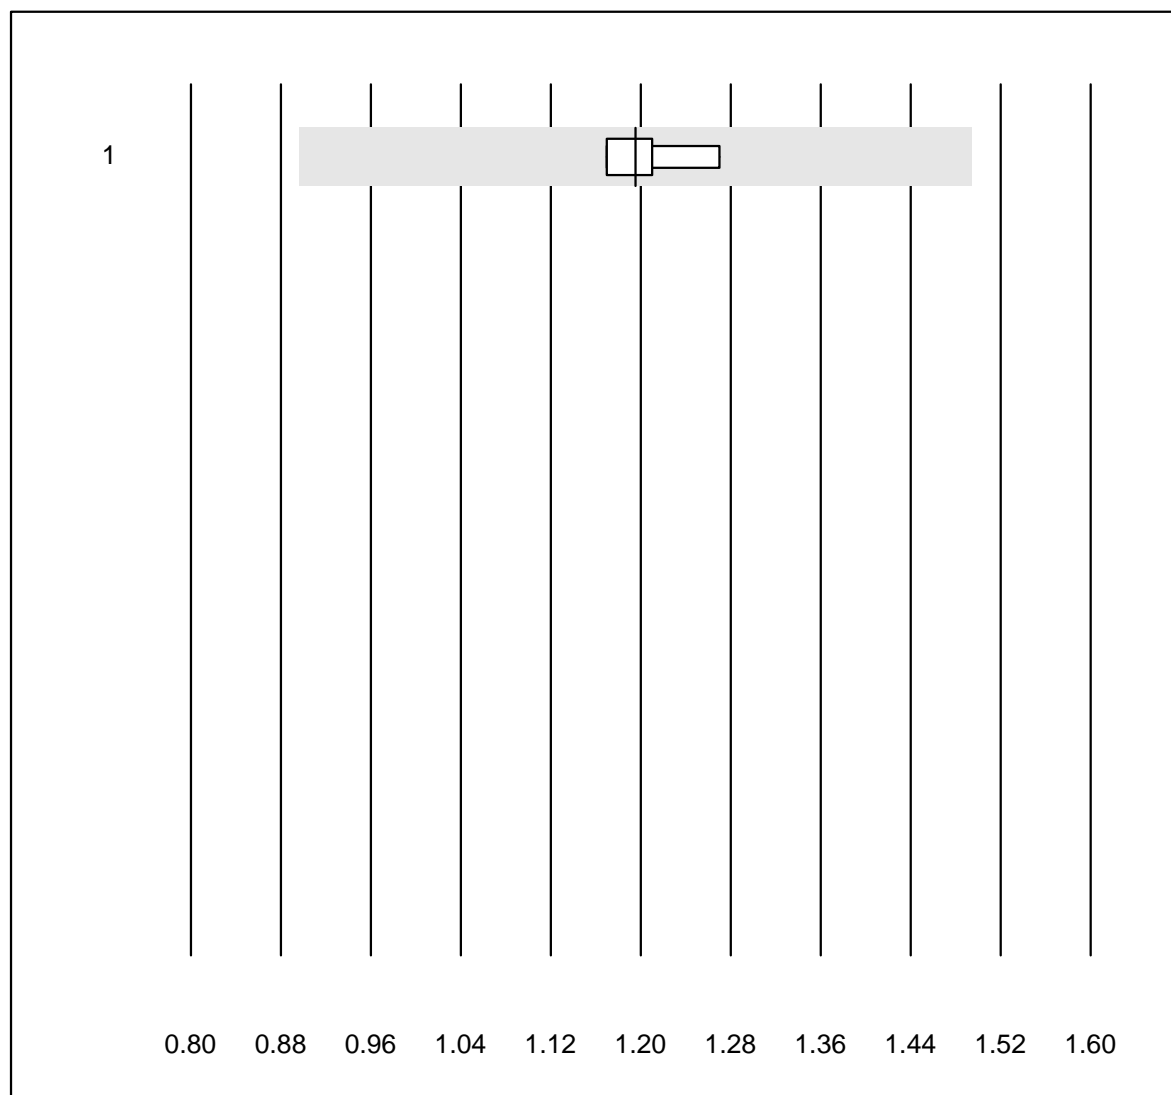


Tolérance QUALAB : 25 %

Alpha-1-Antitrypsine (g/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Nephelometrie	4	100.0	0.0	0.0	1.20	3.7	e


Anti-Streptolysine-Anticorps

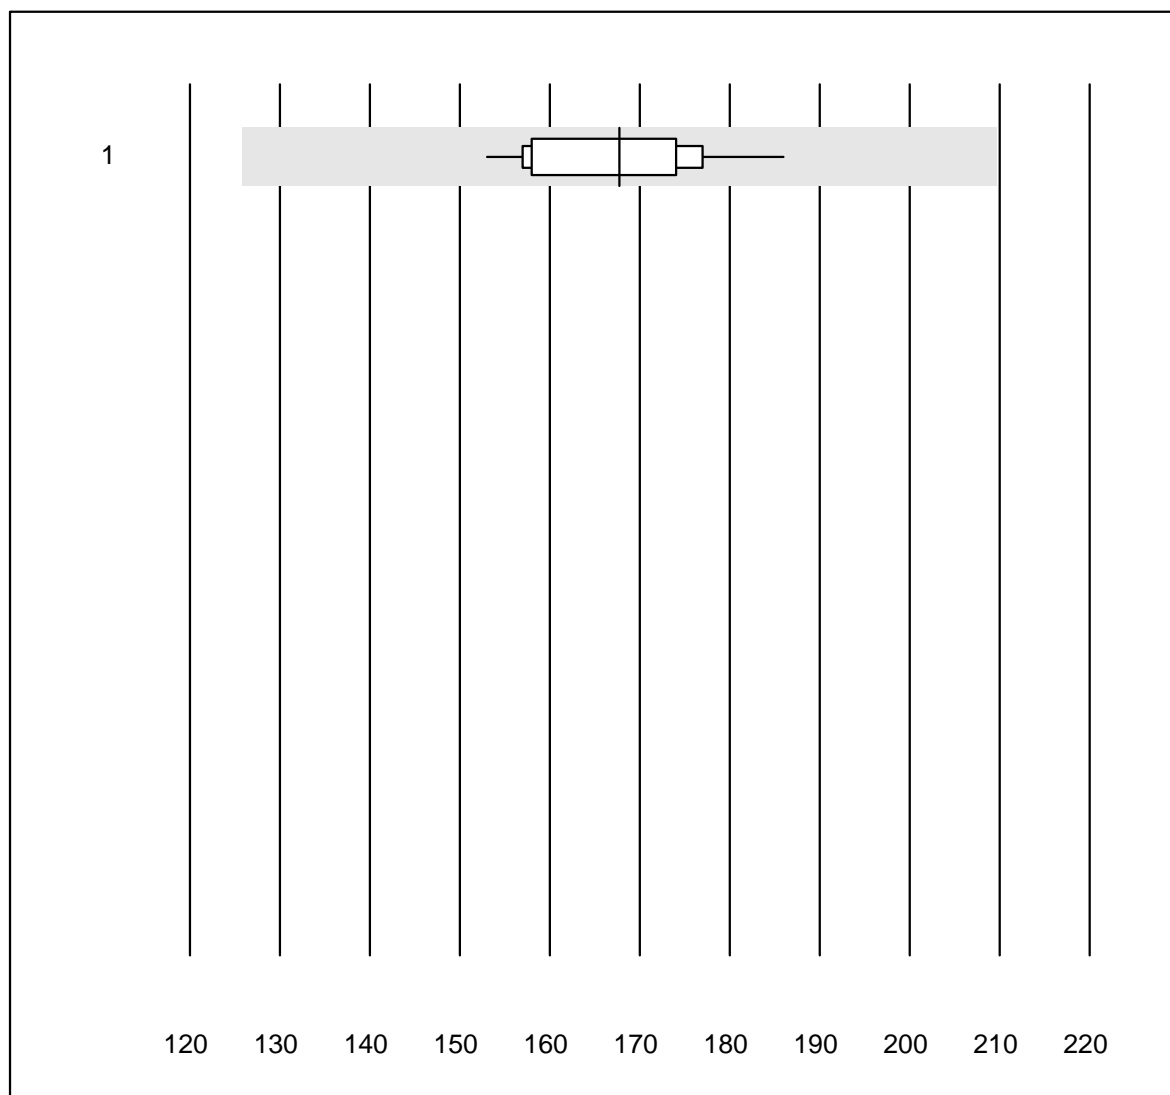

Tolérance QUALAB : 25 % Anti-Streptolysine-Anticorps (kIU/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 toutes les méthodes	11	100.0	0.0	0.0	168	5.8	e

Complément C3

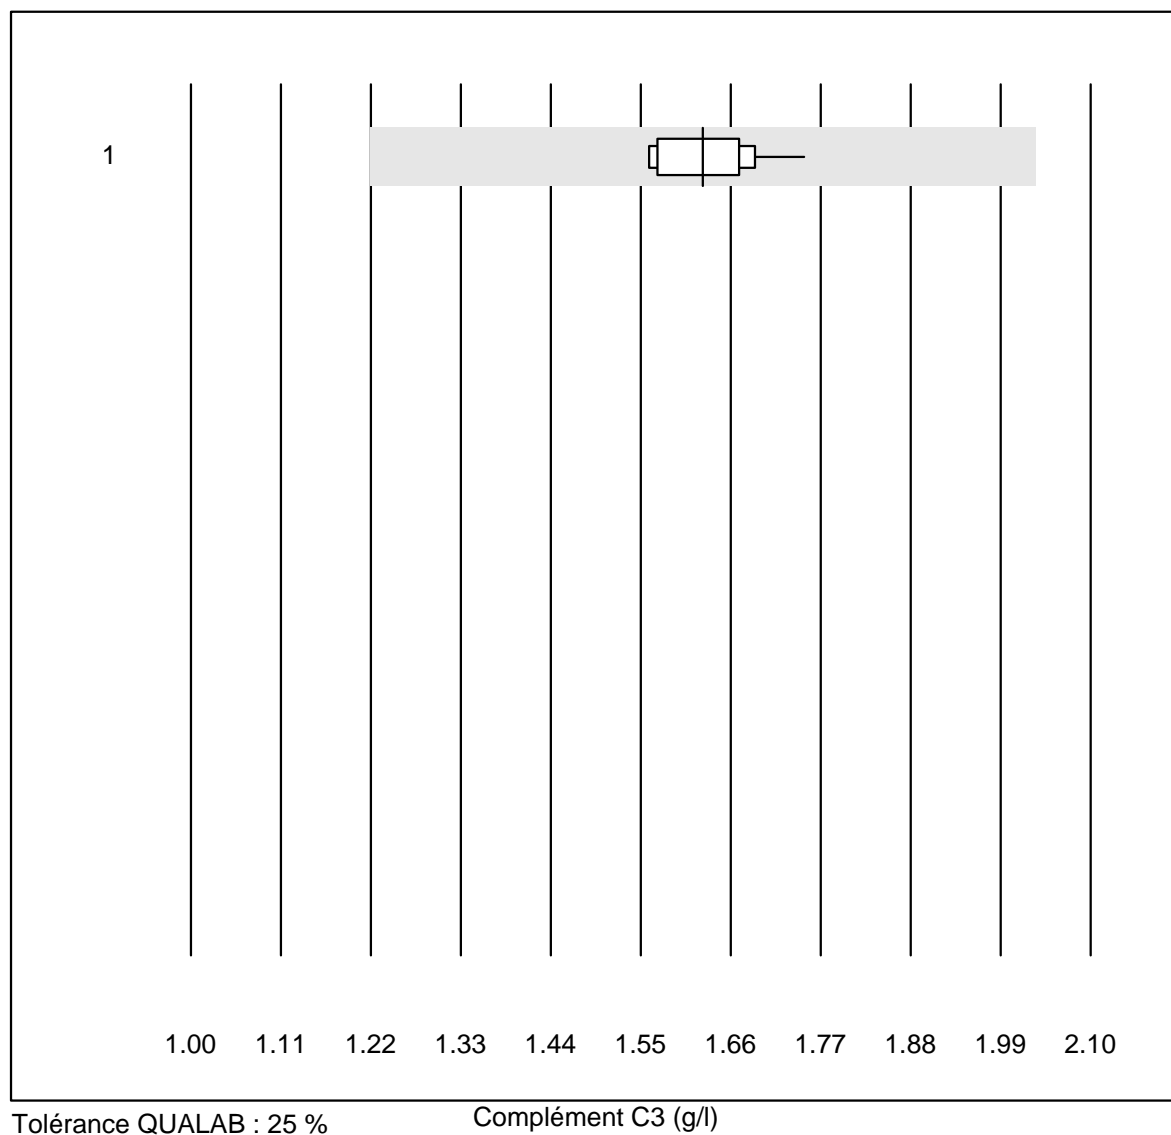

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 toutes les méthodes	13	92.3	0.0	7.7	1.63	3.6	e

Complément C4

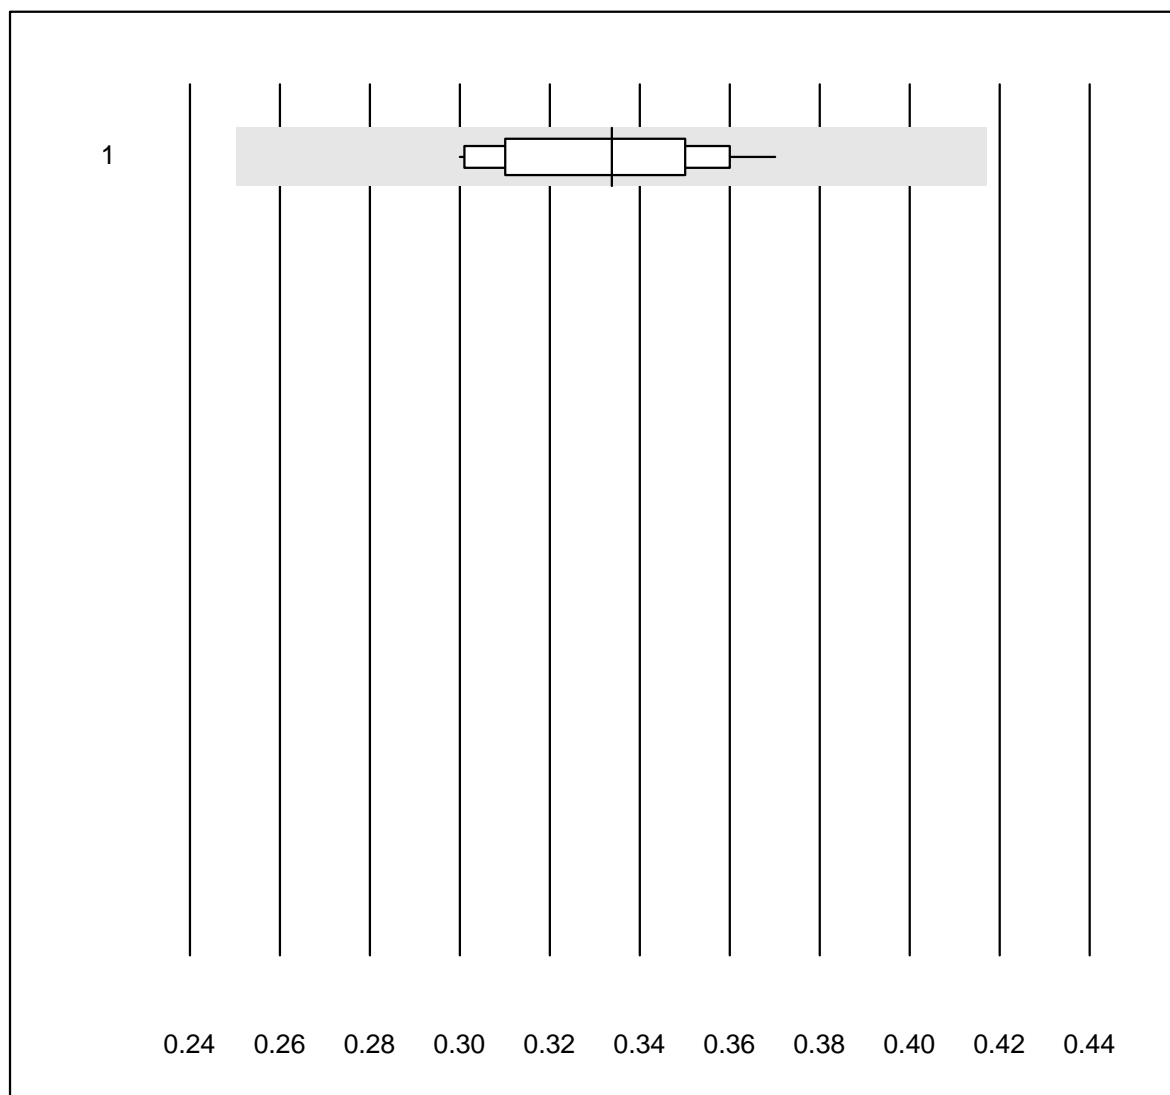


Tolérance QUALAB : 25 %

Complément C4 (g/l)


No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 toutes les méthodes	12	91.7	0.0	8.3	0.33	7.2	e

Haptoglobine

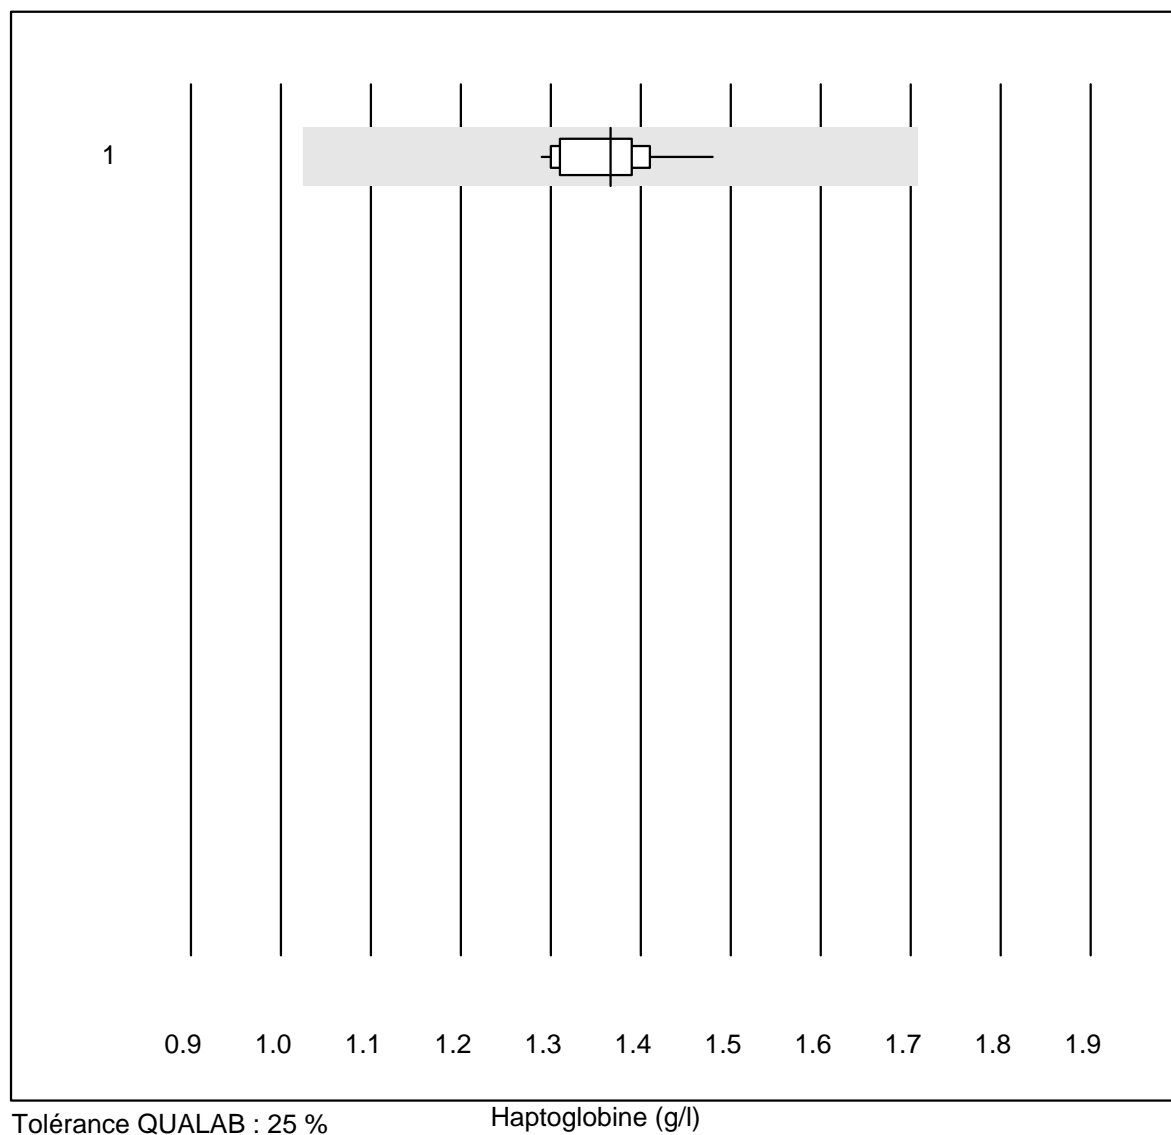


No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 toutes les méthodes	13	100.0	0.0	0.0	1.37	3.9	e

Transferrine

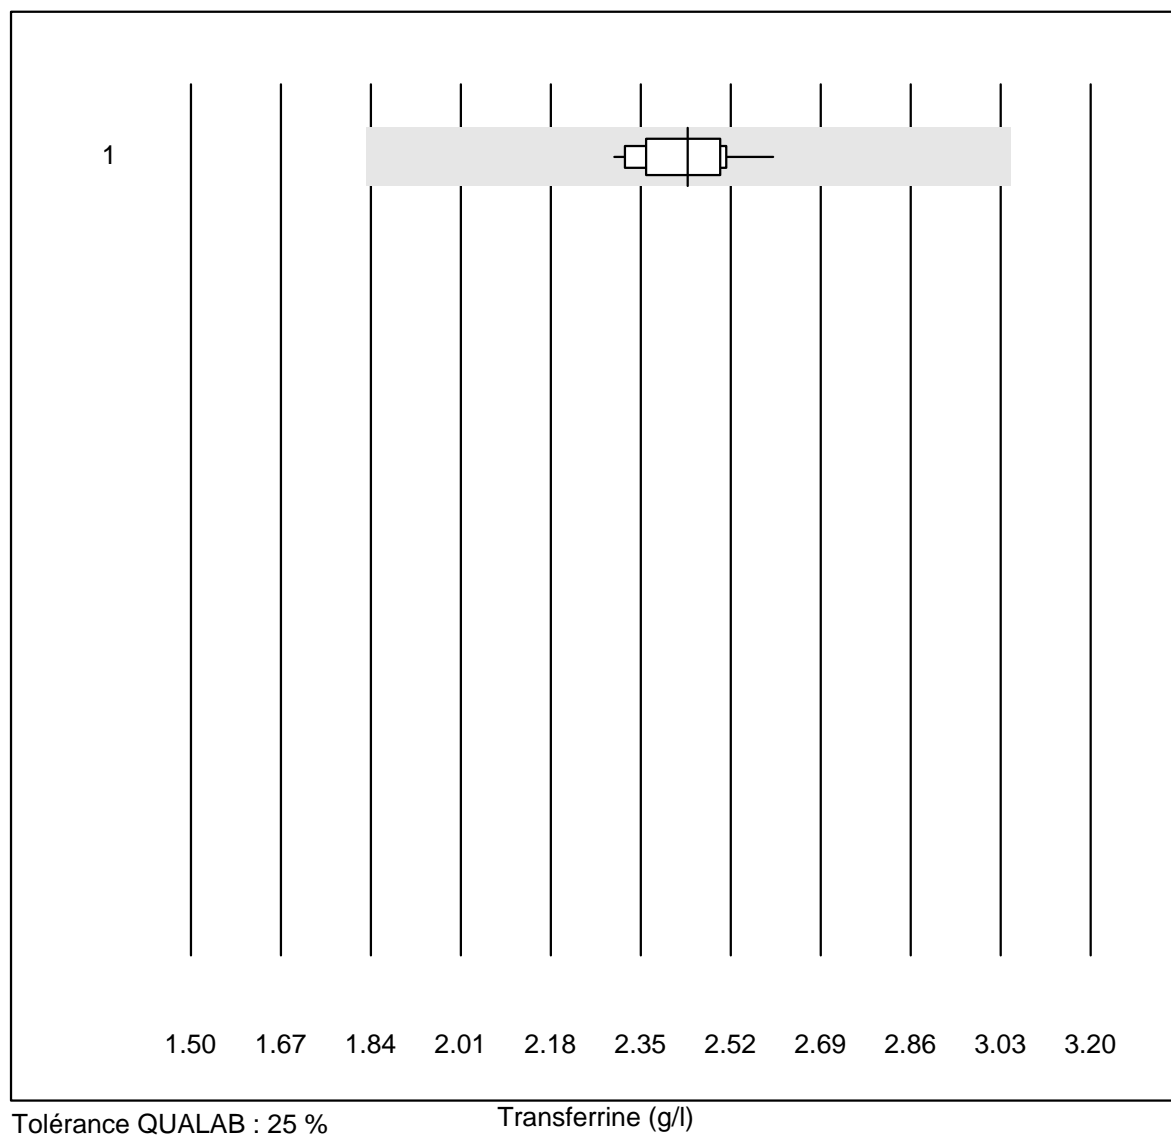

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 toutes les méthodes	18	100.0	0.0	0.0	2.44	3.4	e

Ceruloplasmin

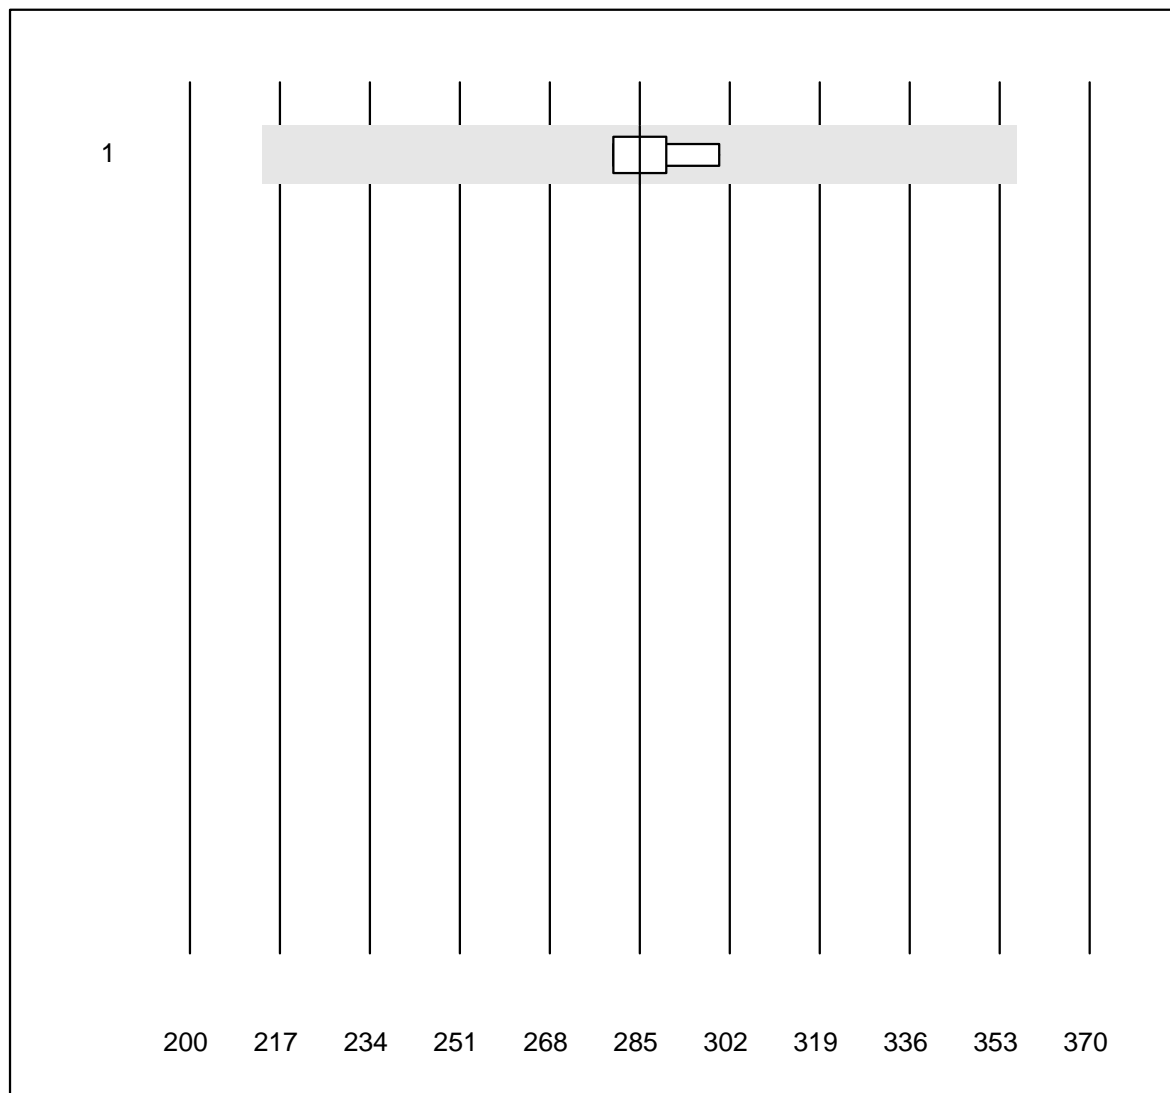


Tolérance QUALAB : 25 %

Ceruloplasmin (mg/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	285.0	3.3	e

Präalbumin

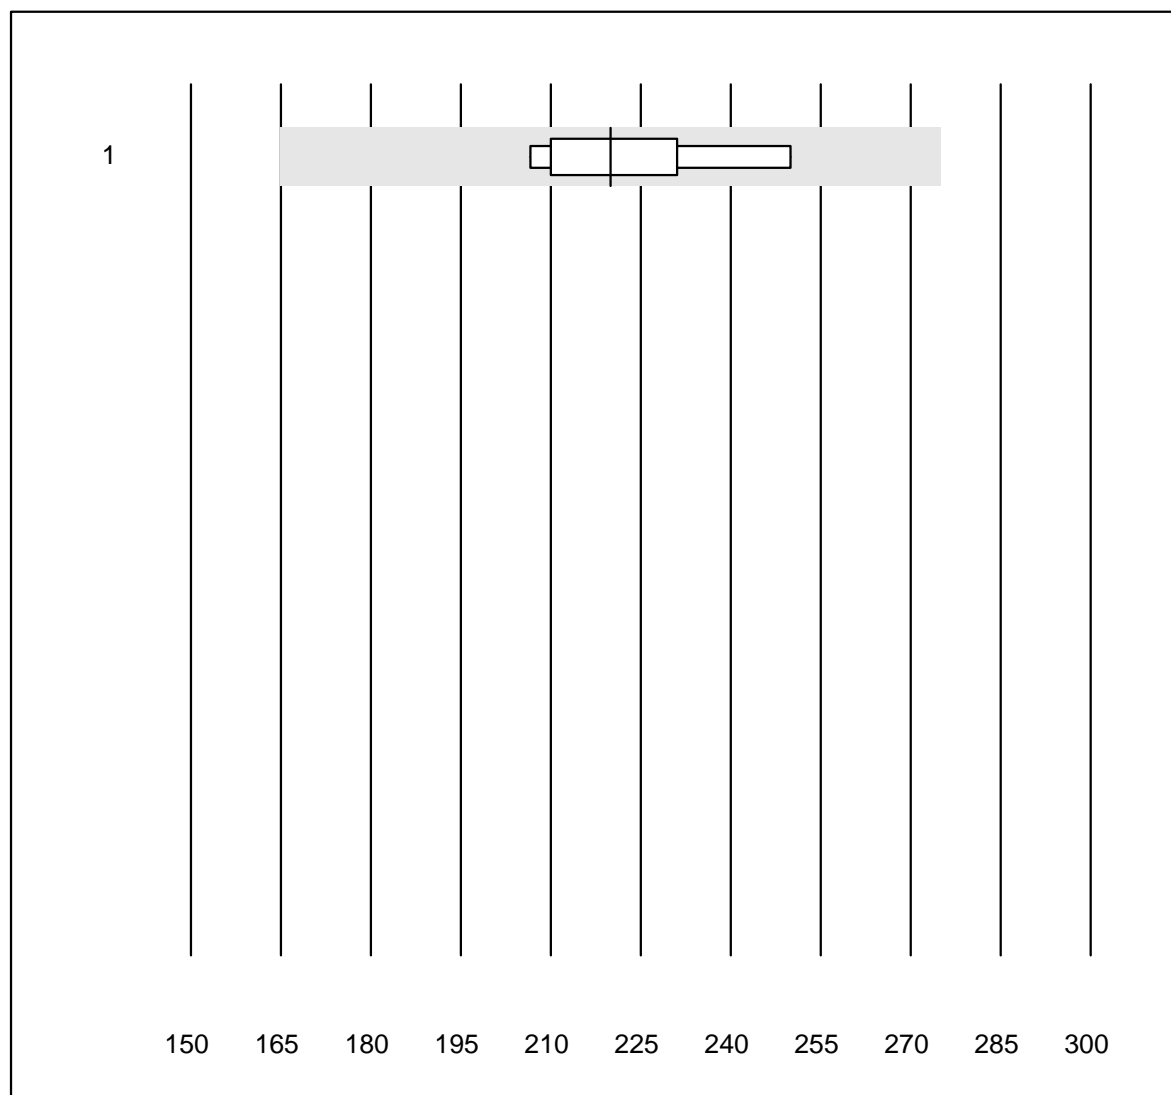


Tolérance QUALAB : 25 %

Präalbumin (mg/l)

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	220.0	6.9 e

Albumine

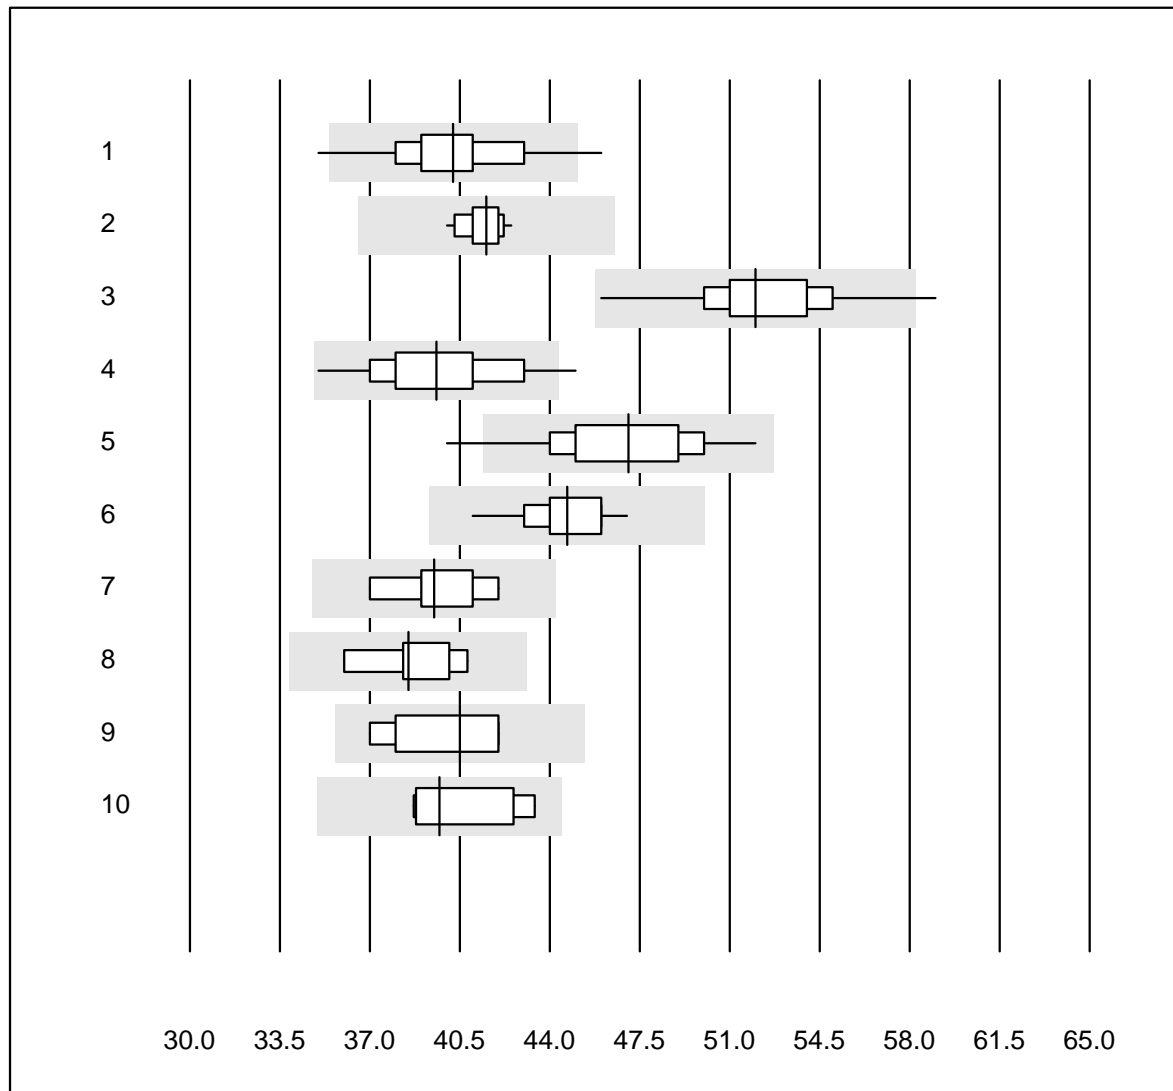


Tolérance QUALAB : 12 %

Albumine (g/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	20	85.0	10.0	5.0	40	5.6	e
2	Cobas	12	100.0	0.0	0.0	42	1.9	e
3	Fuji Dri-Chem	196	99.5	0.5	0.0	52	3.4	e
4	Spotchem/Ready	38	97.4	2.6	0.0	40	5.8	e
5	Spotchem D-Concept	91	96.7	3.3	0.0	47	5.5	e
6	Piccolo	37	100.0	0.0	0.0	45	3.2	e
7	Skyla	6	100.0	0.0	0.0	40	4.4	e*
8	Abx Mira	5	100.0	0.0	0.0	39	4.8	e*
9	Hitachi S40/M40	8	100.0	0.0	0.0	41	4.9	e*
10	Autolyser/DiaSys	5	100.0	0.0	0.0	40	5.4	e*

Phosphatase alcaline

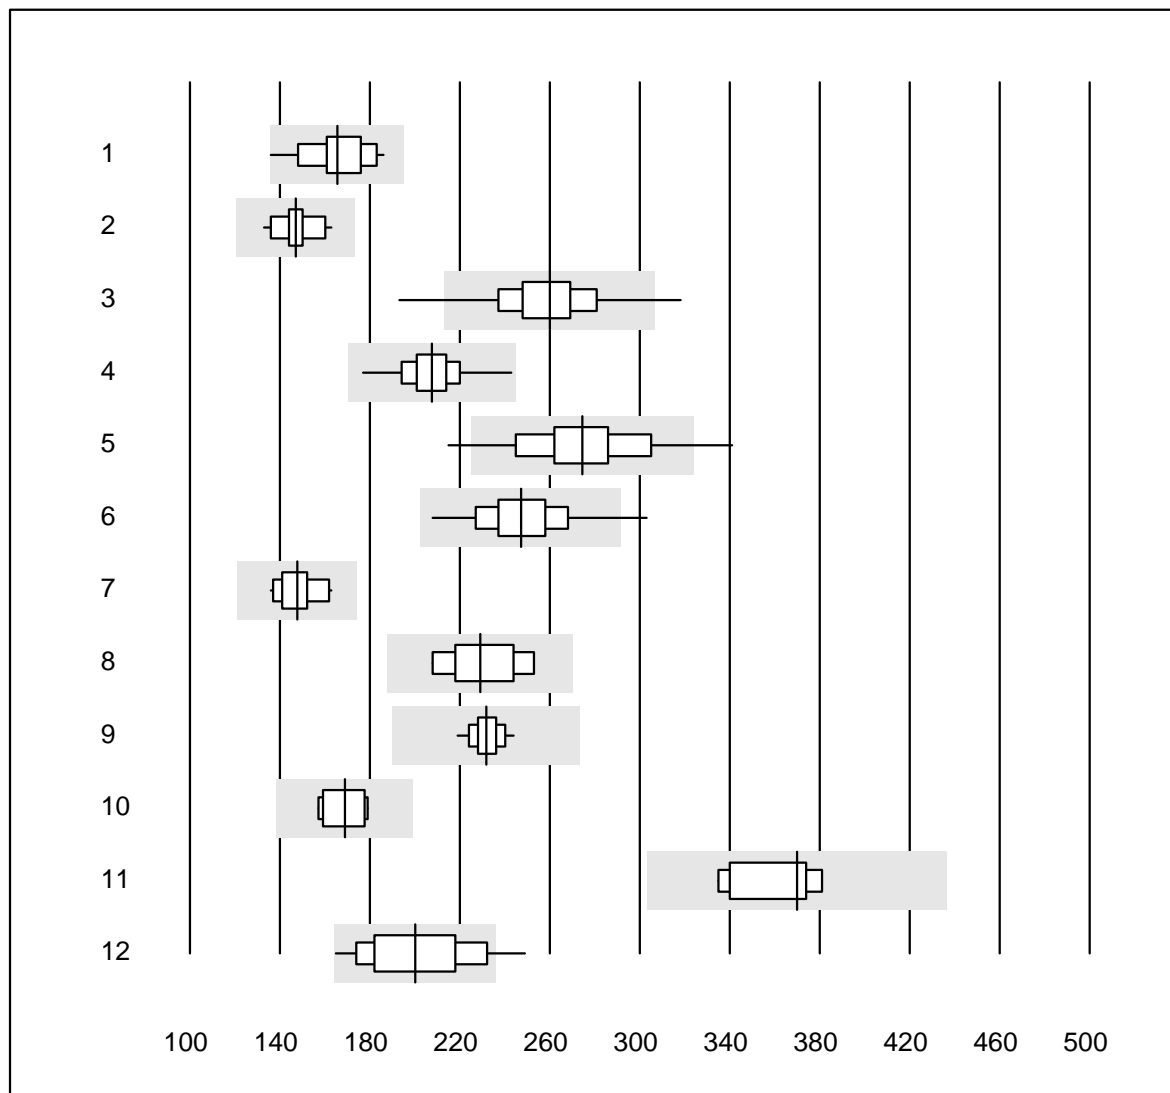


Tolérance QUALAB : 18 %

Phosphatase alcaline (U/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 IFCC	12	100.0	0.0	0.0	166	8.6	e*
2 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	147	5.2	e
3 Reflotron	629	97.5	1.7	0.8	260	7.0	e
4 Fuji Dri-Chem	708	99.4	0.0	0.6	208	4.8	e
5 Spotchem/Ready	98	91.9	7.1	1.0	274	8.5	e
6 Spotchem D-Concept	164	99.4	0.6	0.0	247	6.6	e
7 Hitachi S40/M40	16	100.0	0.0	0.0	148	5.5	e
8 Beckman	9	100.0	0.0	0.0	229	7.0	e*
9 Piccolo	35	97.1	0.0	2.9	232	2.7	e
10 Abx Mira	8	87.5	0.0	12.5	169	6.0	e
11 Skyla	5	100.0	0.0	0.0	370	5.8	e*
12 Autolyser/DiaSys	14	92.9	7.1	0.0	200	12.2	e*

Amylase

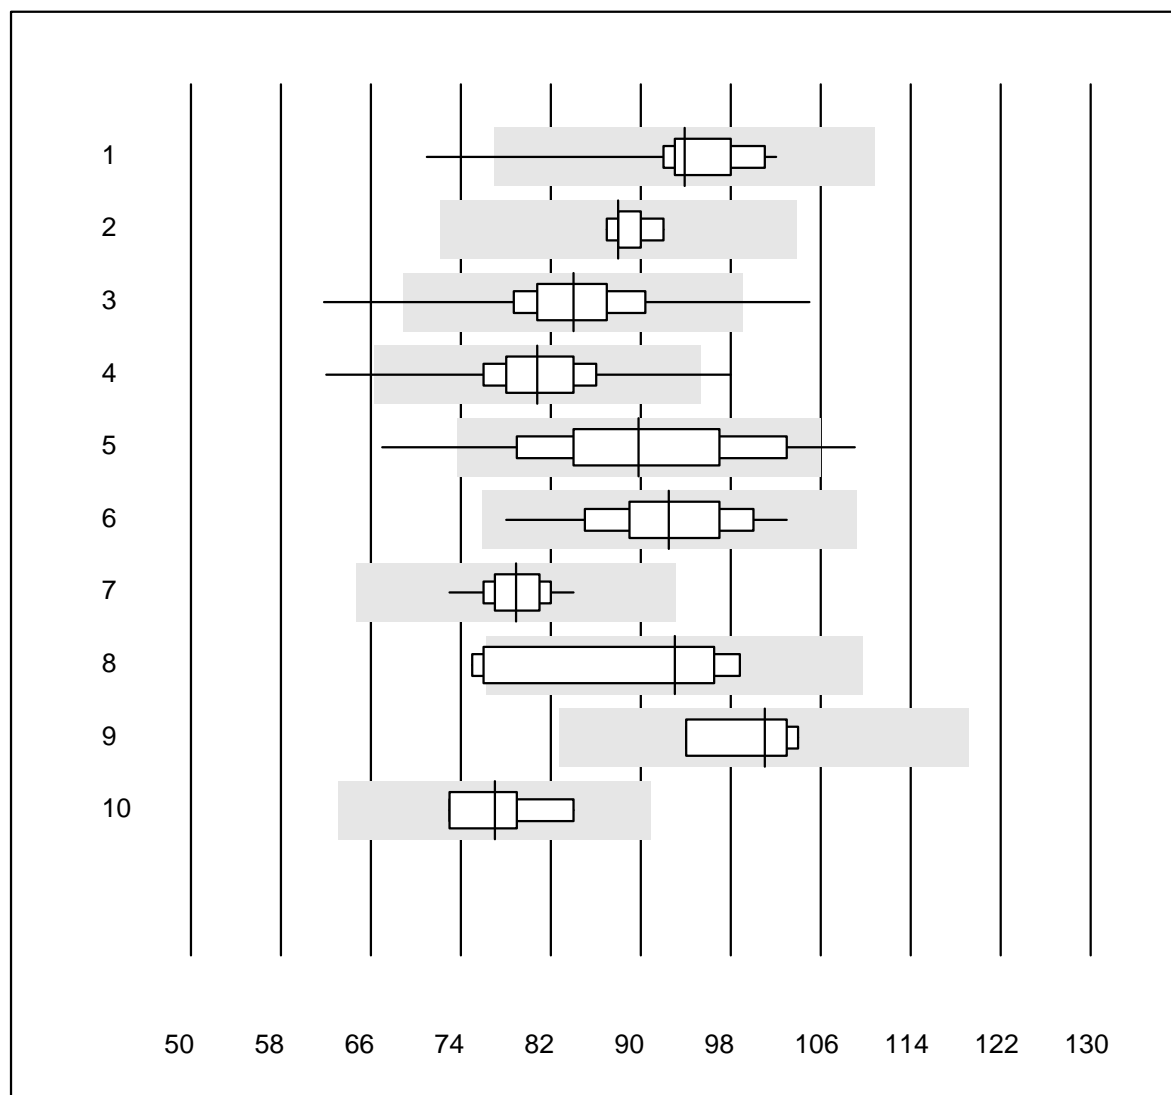


Tolérance QUALAB : 18 %

Amylase (U/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 IFCC	12	91.7	8.3	0.0	94	8.4	e*
2 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	88	2.2	e
3 Reflotron	170	95.3	2.9	1.8	84	6.5	e
4 Fuji Dri-Chem	523	98.4	0.6	1.0	81	5.0	e
5 Spotchem/Ready	64	82.8	12.5	4.7	90	11.1	e
6 Spotchem D-Concept	127	99.2	0.0	0.8	93	5.9	e
7 Piccolo	32	100.0	0.0	0.0	79	3.3	e
8 Abx Mira	5	60.0	40.0	0.0	93	13.1	e*
9 Hitachi S40/M40	9	100.0	0.0	0.0	101	4.5	e
10 Autolyser/DiaSys	4	100.0	0.0	0.0	77	6.2	e*

Amylase pancréatique

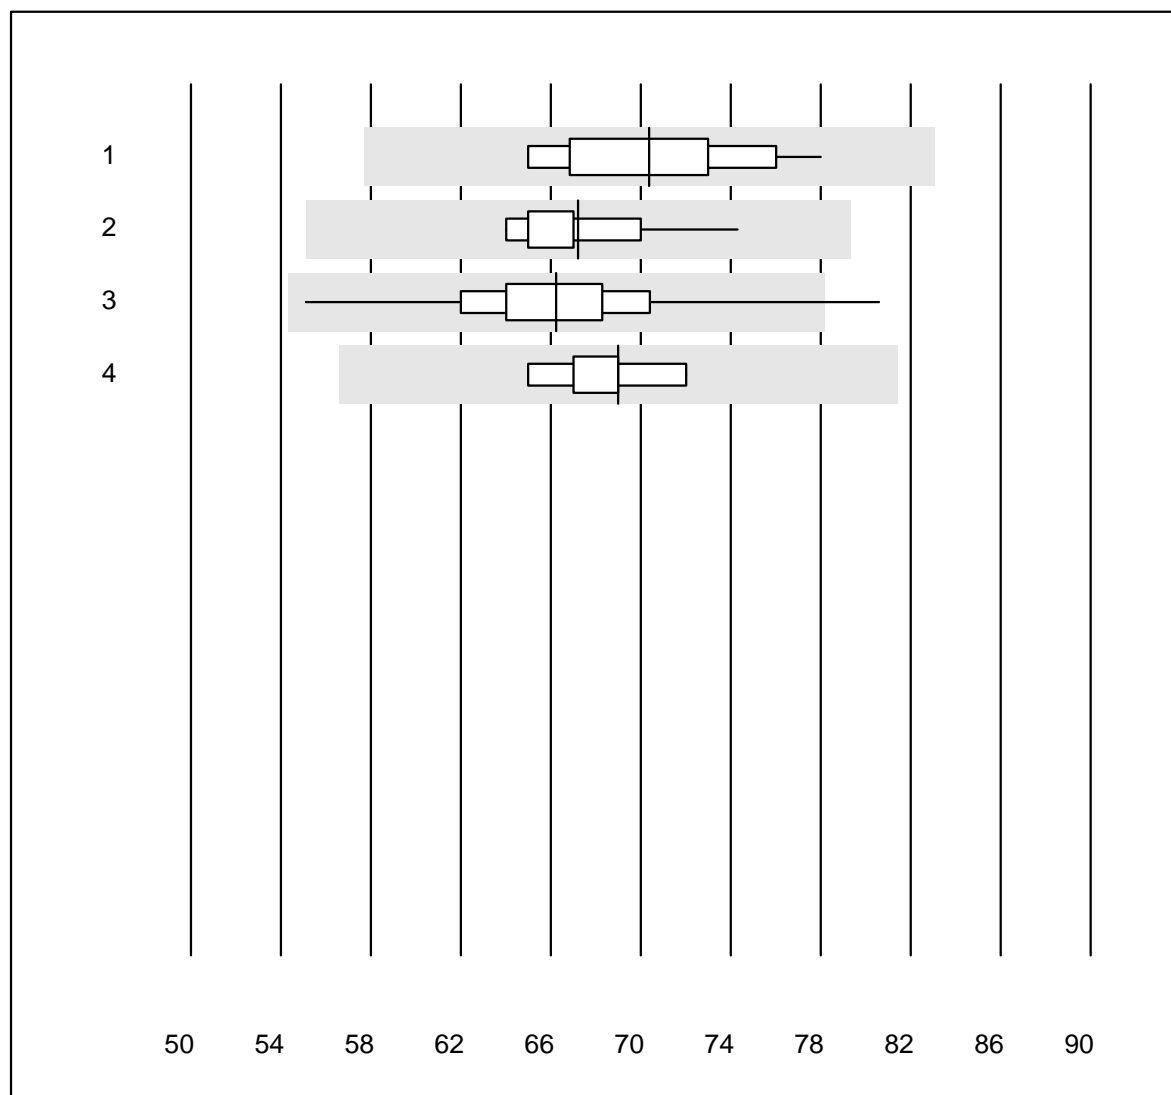


Tolérance QUALAB : 18 %

Amylase pancréatique (U/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 IFCC	12	100.0	0.0	0.0	70	6.4	e
2 Cobas	12	100.0	0.0	0.0	67	4.1	e
3 Reflotron	424	98.8	0.5	0.7	66	5.2	e
4 Autolyser/DiaSys	9	100.0	0.0	0.0	69	3.0	e

Bilirubine totale

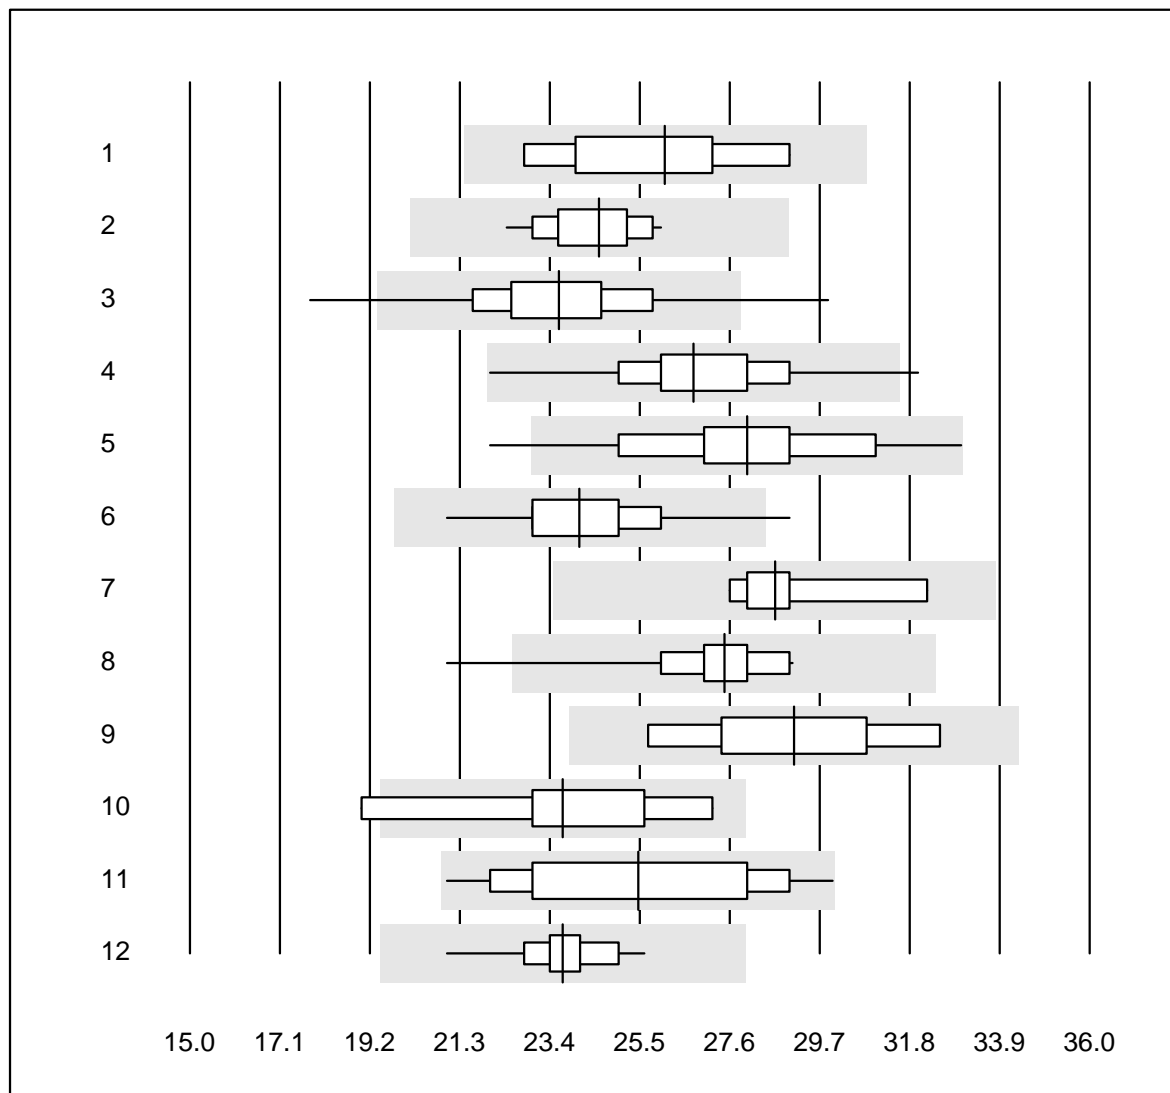


Tolérance QUALAB : 18 %

Bilirubine totale (µmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	11	90.9	0.0	9.1	26.1	8.1	e*
2	Cobas	16	100.0	0.0	0.0	24.6	4.2	e
3	Reflotron	460	93.9	3.3	2.8	23.6	7.5	e
4	Fuji Dri-Chem	546	98.2	0.2	1.6	26.8	5.6	e
5	Spotchem/Ready	82	95.2	2.4	2.4	28.0	7.9	e
6	Spotchem D-Concept	135	99.3	0.7	0.0	24.1	5.2	e
7	Beckman	8	100.0	0.0	0.0	28.7	5.0	e
8	Piccolo	36	97.2	2.8	0.0	27.5	5.9	e
9	Skyla	5	100.0	0.0	0.0	29.1	9.2	e*
10	Abx Mira	7	71.4	14.3	14.3	23.7	11.8	e*
11	Hitachi S40/M40	14	92.9	0.0	7.1	25.5	10.9	e*
12	Autolyser/DiaSys	13	100.0	0.0	0.0	23.7	4.8	e

Bilirubine directe

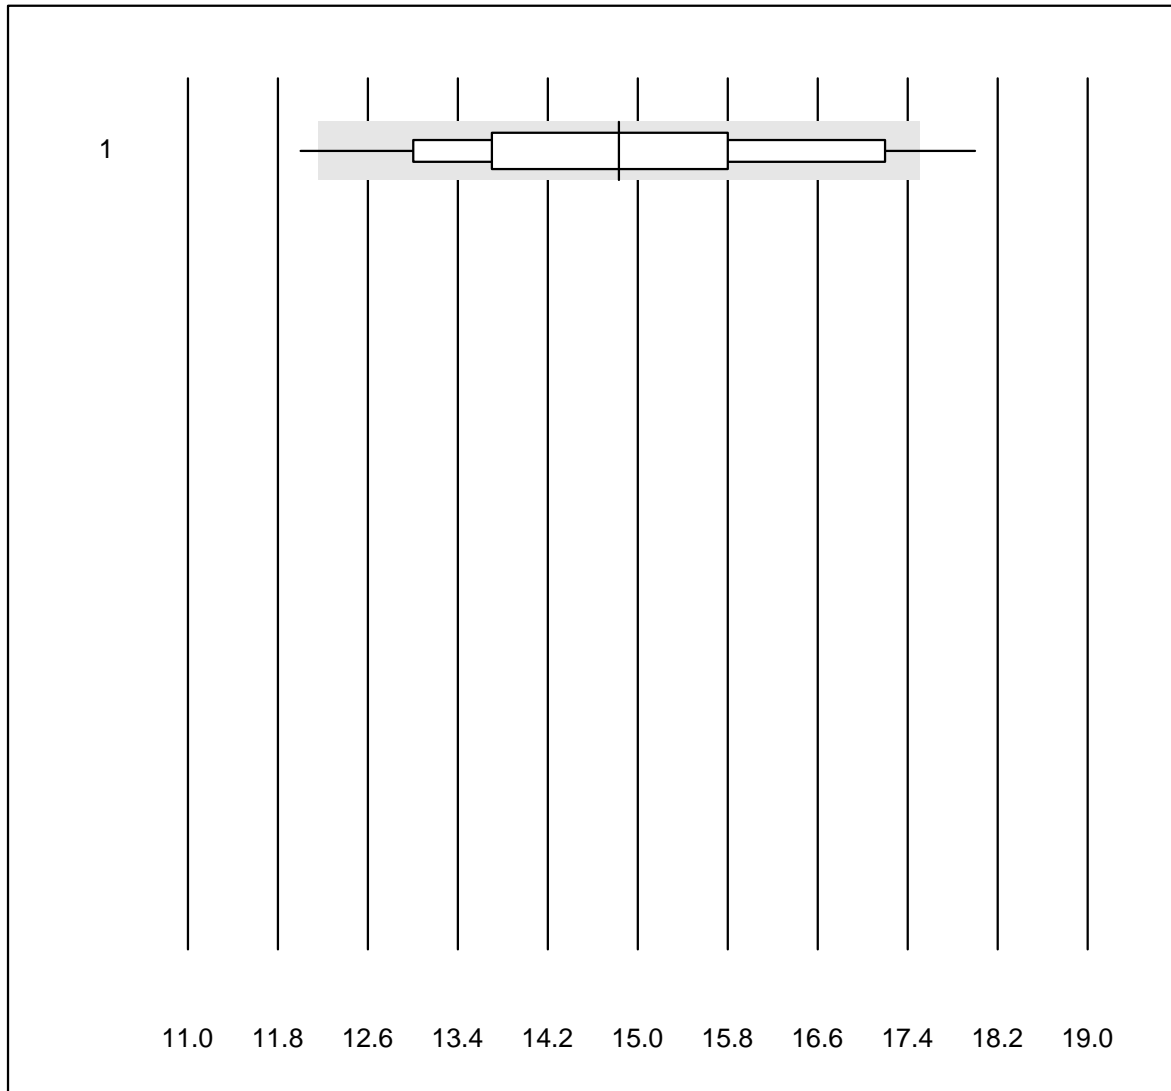


Tolérance QUALAB : 18 %

Bilirubine directe ($\mu\text{mol/l}$)

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Fuji Dri-Chem	32	81.2	6.3	12.5	14.8	10.4	e

Calcium

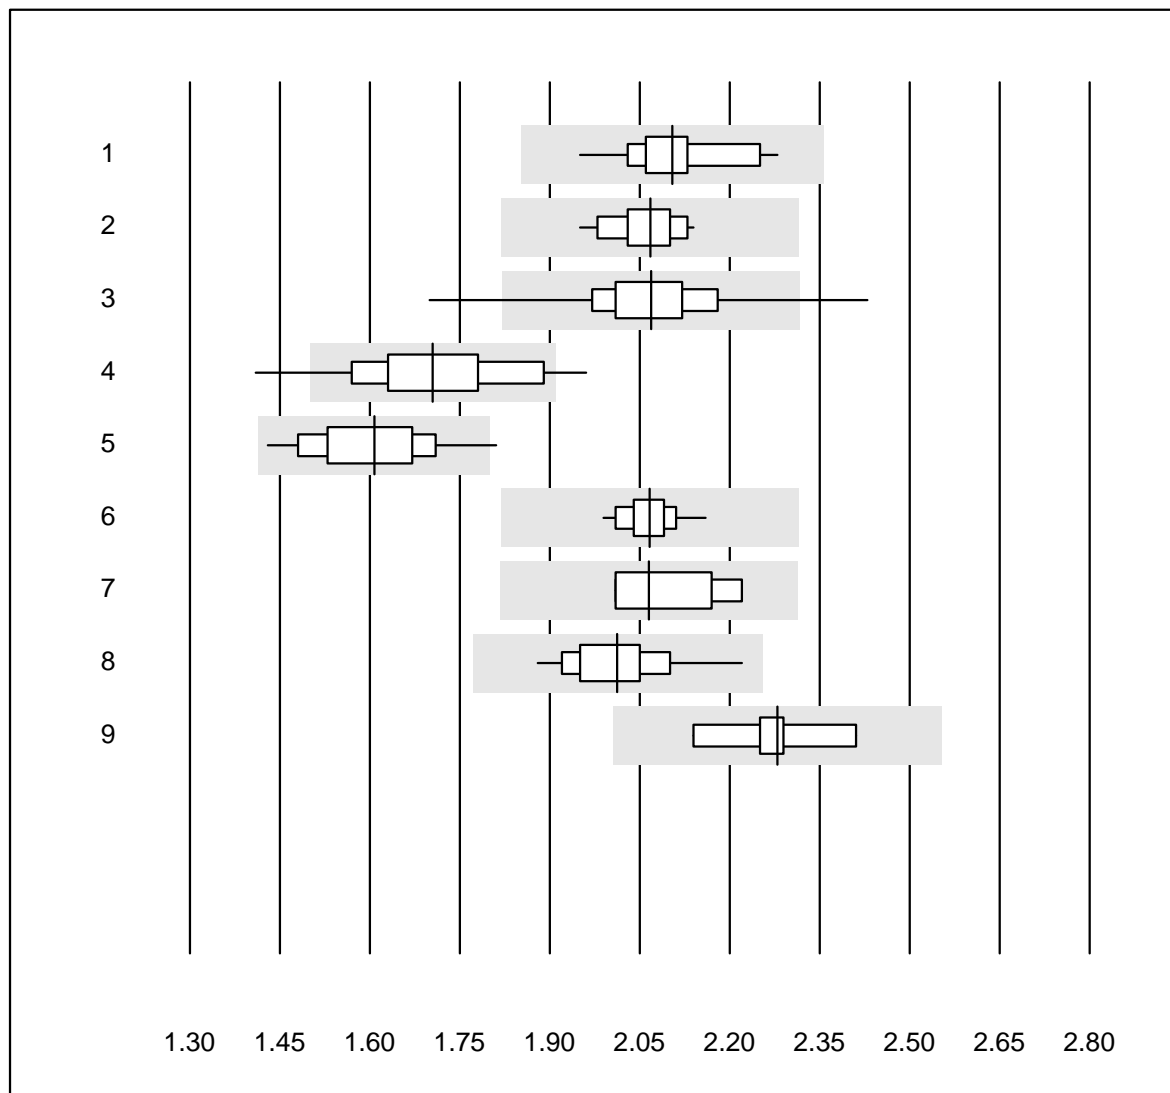


Tolérance QUALAB : 12 %

Calcium (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	24	95.8	0.0	4.2	2.10	3.8	e
2	Cobas	12	100.0	0.0	0.0	2.07	2.8	e
3	Fuji Dri-Chem	357	96.3	2.0	1.7	2.07	4.4	e
4	Spotchem/Ready	36	83.3	13.9	2.8	1.71	7.5	e
5	Spotchem D-Concept	74	93.2	1.4	5.4	1.61	5.6	e
6	Piccolo	35	100.0	0.0	0.0	2.07	2.0	e
7	Abx Mira	6	83.3	0.0	16.7	2.07	4.5	e*
8	Hitachi S40/M40	12	100.0	0.0	0.0	2.01	4.5	e
9	Autolyser/DiaSys	6	100.0	0.0	0.0	2.28	3.8	e*

Calcium ISE

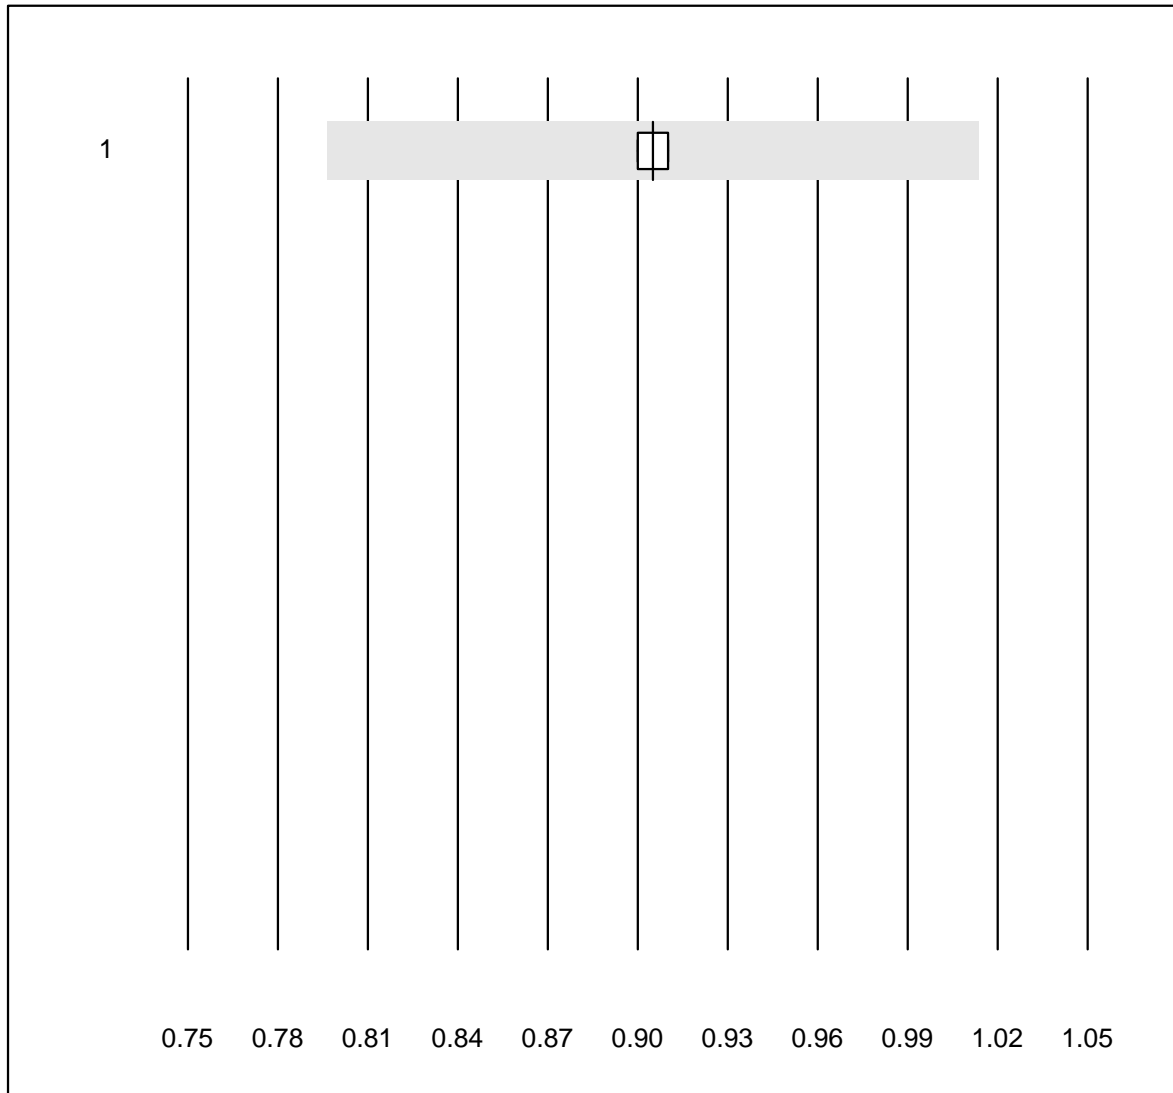


Tolérance QUALAB : 12 %

Calcium ISE (mmol/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 iStat Chem8	4	100.0	0.0	0.0	0.91	0.6	e

Chlorures

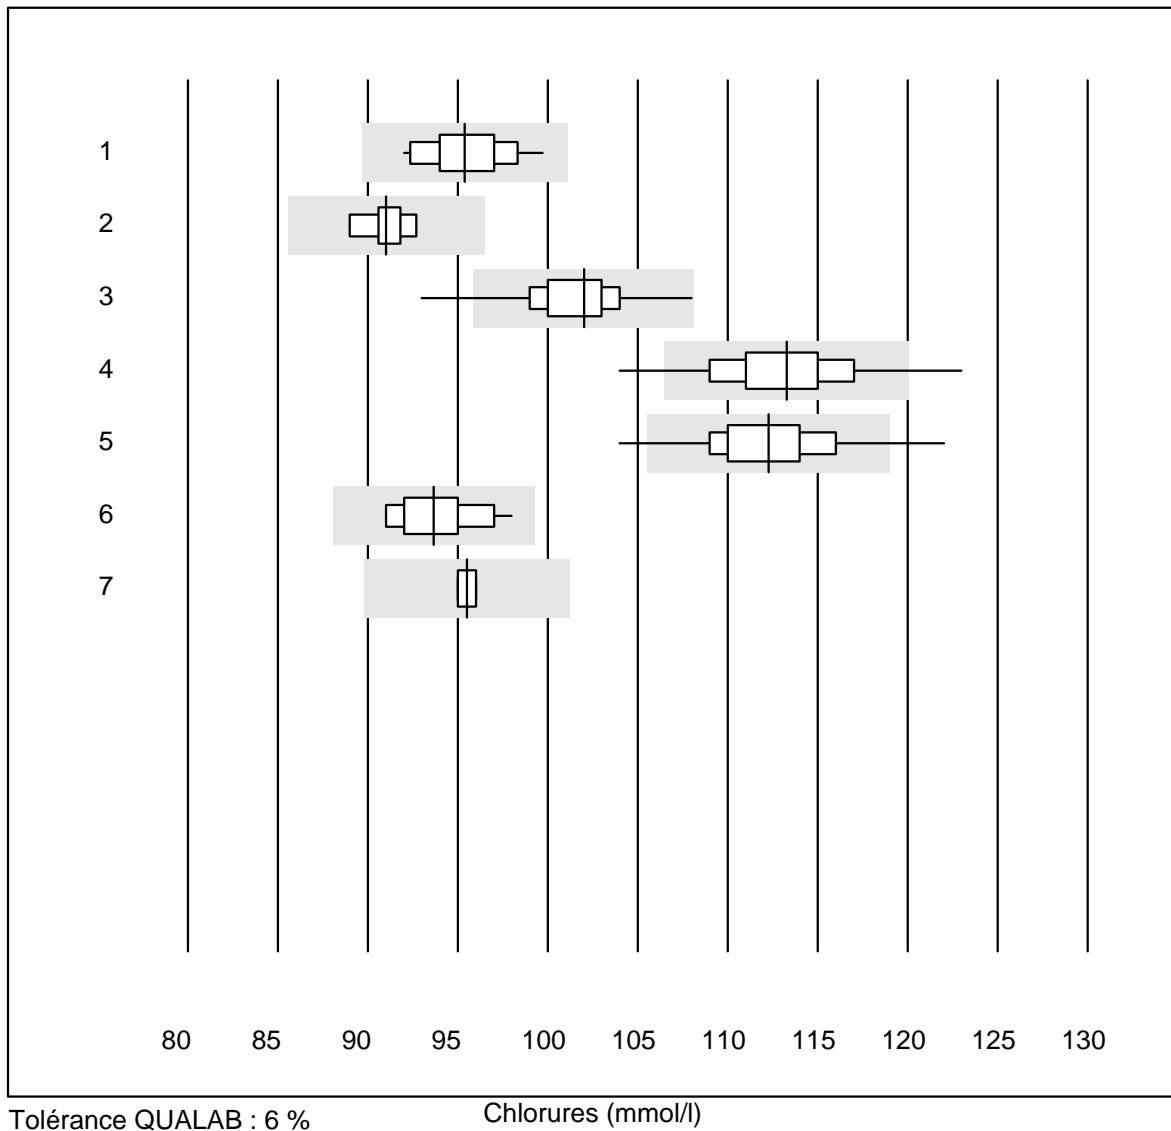

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ISE	18	94.4	0.0	5.6	95	2.3	e
2 Cobas	7	100.0	0.0	0.0	91	1.3	e
3 Fuji Dri-Chem	653	96.4	2.5	1.1	102	2.2	e
4 Spotchem D-Concept	153	94.1	3.3	2.6	113	2.7	e
5 Spotchem EL-SE 1520	111	91.9	5.4	2.7	112	2.8	e
6 Piccolo	18	100.0	0.0	0.0	94	2.3	e
7 iStat Chem8	4	100.0	0.0	0.0	96	0.6	e

Cholestérol

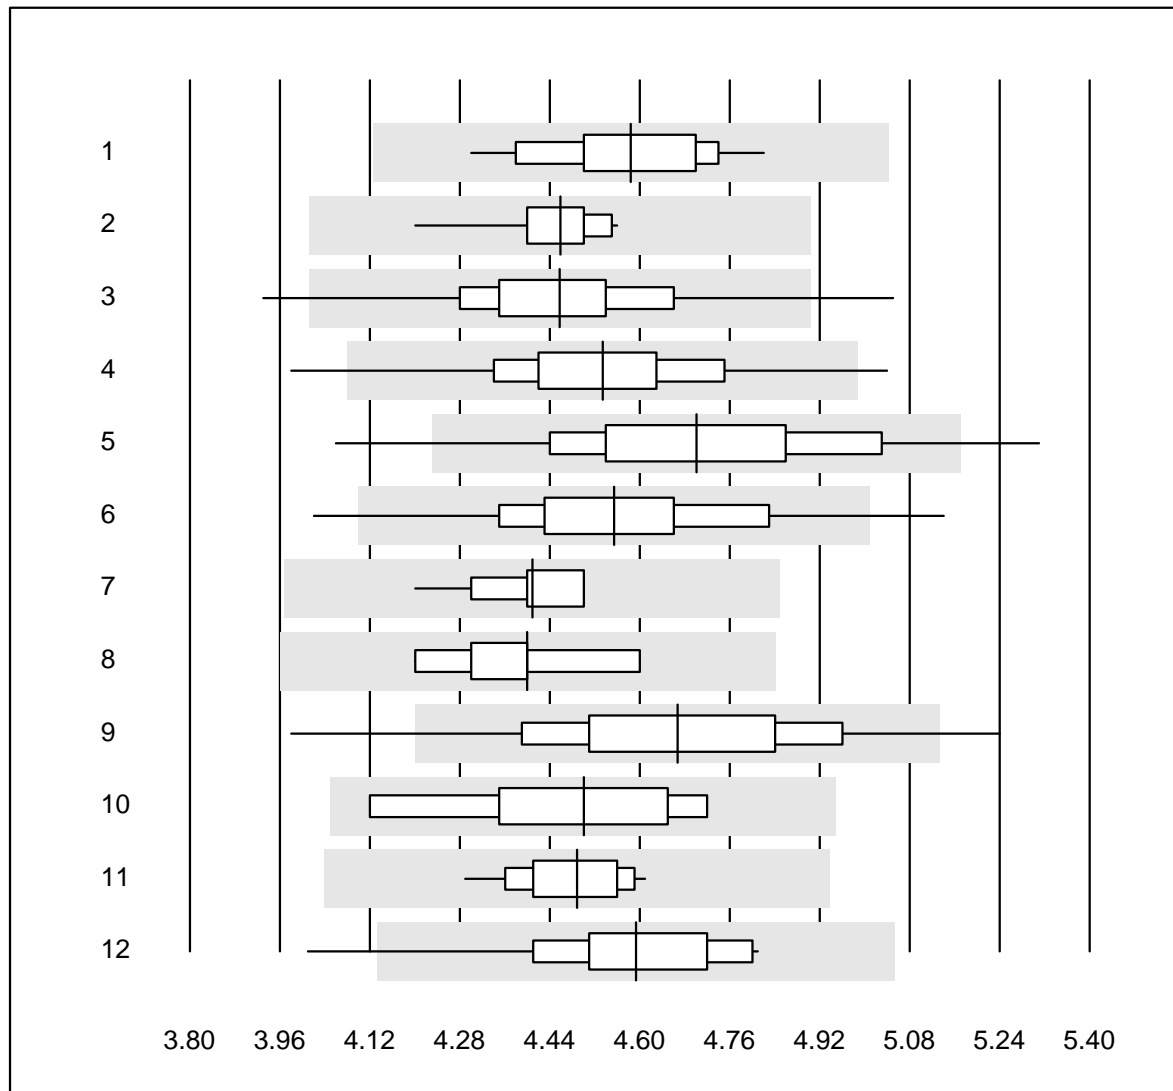


Tolérance QUALAB : 10 %

Cholestérol (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	20	100.0	0.0	0.0	4.58	3.2	e
2	Cobas	15	100.0	0.0	0.0	4.46	2.0	e
3	Reflotron	683	97.4	1.6	1.0	4.46	3.5	e
4	Fuji Dri-Chem	722	98.3	0.7	1.0	4.53	3.5	e
5	Spotchem/Ready	125	92.8	5.6	1.6	4.70	5.1	e
6	Spotchem D-Concept	170	95.3	2.9	1.8	4.55	4.1	e
7	Piccolo	21	100.0	0.0	0.0	4.41	1.7	e
8	Skyla	5	100.0	0.0	0.0	4.40	3.4	e*
9	Cholestech LDX	182	93.5	4.9	1.6	4.67	5.1	e
10	Abx Mira	9	88.9	0.0	11.1	4.50	4.4	e*
11	Hitachi S40/M40	16	100.0	0.0	0.0	4.49	2.0	e
12	Autolyser/DiaSys	13	92.3	7.7	0.0	4.59	4.8	e*

Cholestérol HDL

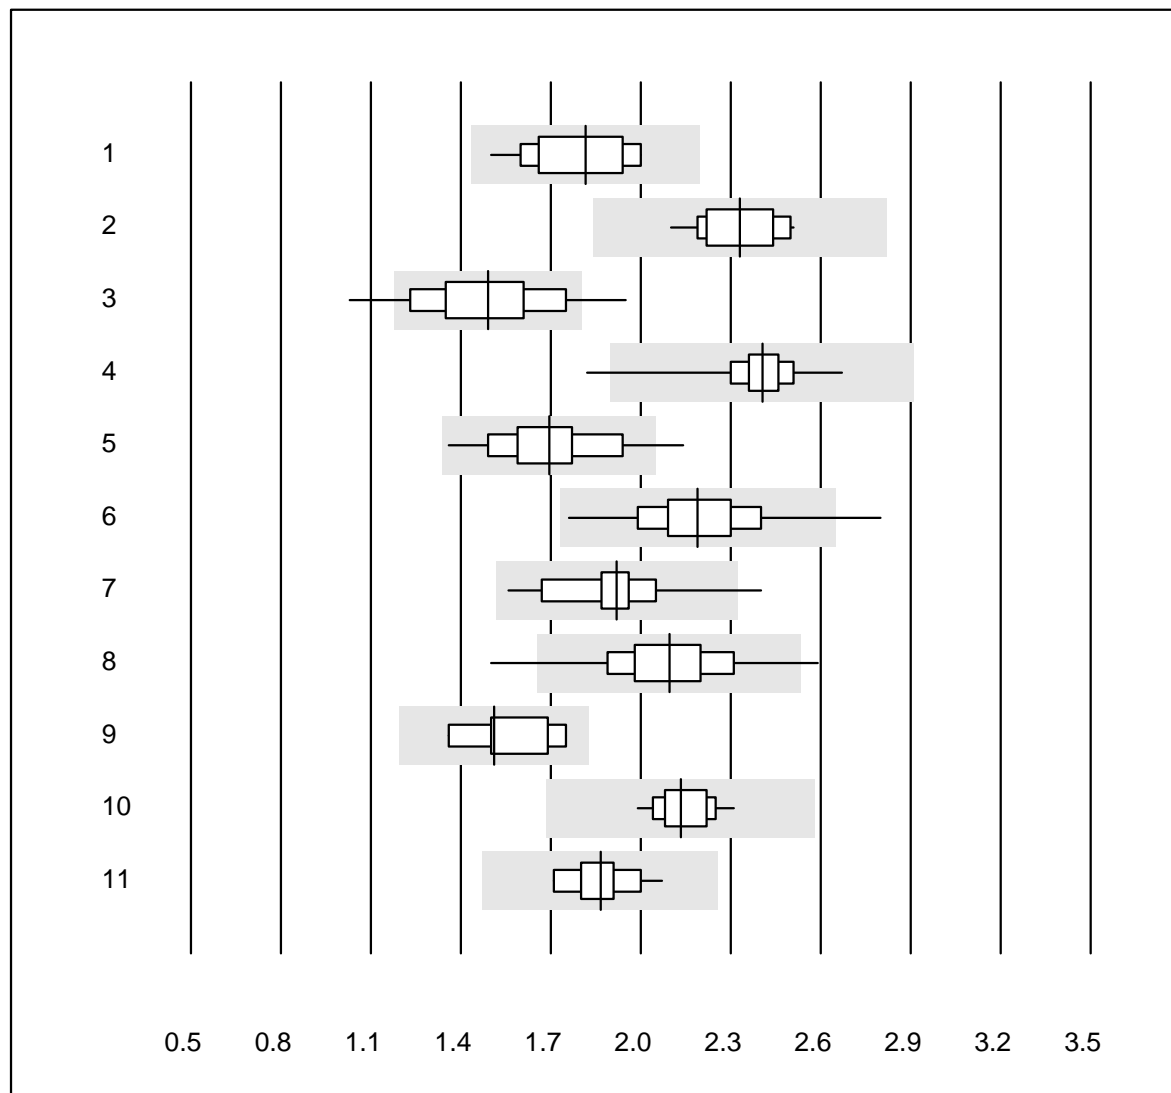


Tolérance QUALAB : 21 %

Cholestérol HDL (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	humide, direct	14	100.0	0.0	0.0	1.82	9.0	e
2	Cobas	15	100.0	0.0	0.0	2.33	5.3	e
3	Reflotron	507	84.0	10.7	5.3	1.49	13.2	e
4	Fuji Dri-Chem	688	98.8	0.3	0.9	2.40	3.7	e
5	Spotchem/Ready	111	94.6	3.6	1.8	1.70	9.6	e
6	Spotchem D-Concept	168	98.8	1.2	0.0	2.19	7.9	e
7	Piccolo	21	90.4	4.8	4.8	1.92	9.1	e
8	Cholestech LDX	182	96.2	2.2	1.6	2.09	8.1	e
9	Abx Mira	7	71.4	0.0	28.6	1.51	10.1	e*
10	Hitachi S40/M40	15	100.0	0.0	0.0	2.13	4.1	e
11	Autolyser/DiaSys	13	100.0	0.0	0.0	1.87	5.8	e

Créatine-kinase

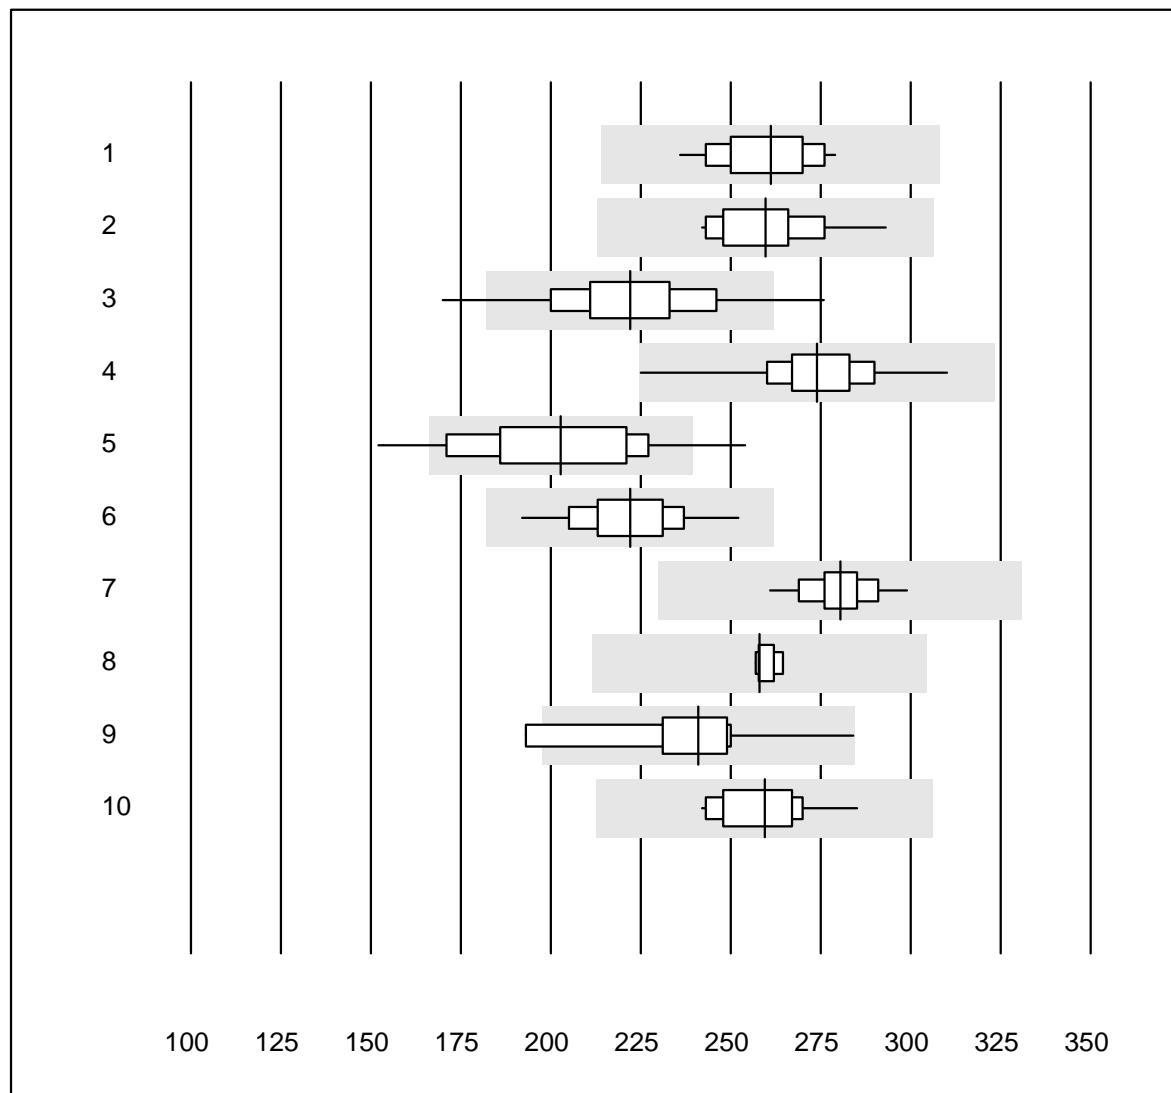


Tolérance QUALAB : 18 %

Créatine-kinase (U/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 IFCC	20	100.0	0.0	0.0	261	4.6	e
2 Cobas	15	100.0	0.0	0.0	260	5.4	e
3 Reflotron	385	93.8	3.1	3.1	222	8.2	e
4 Fuji Dri-Chem	457	98.0	0.0	2.0	274	4.6	e
5 Spotchem/Ready	51	90.2	7.8	2.0	203	11.3	e
6 Spotchem D-Concept	109	100.0	0.0	0.0	222	5.8	e
7 Piccolo	15	100.0	0.0	0.0	280	3.2	e
8 Abx Mira	6	83.3	0.0	16.7	258	1.2	e
9 Hitachi S40/M40	10	90.0	10.0	0.0	241	9.5	e*
10 Autolyser/DiaSys	12	91.7	0.0	8.3	259	5.0	e

Fer

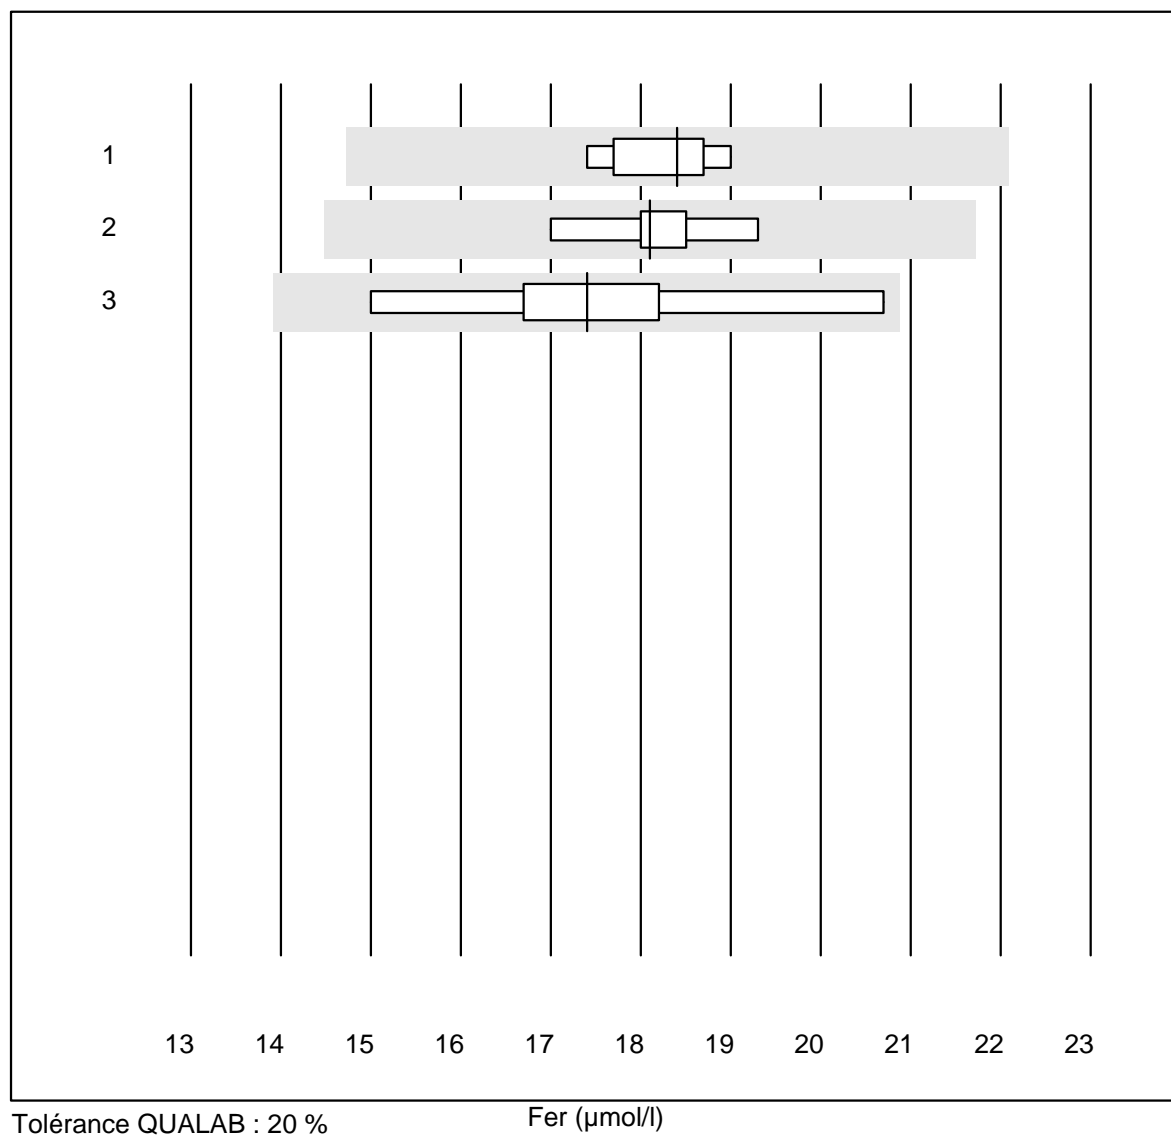

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	8	100.0	0.0	0.0	18	3.2	e
2	Cobas	9	100.0	0.0	0.0	18	4.0	e
3	Abx Mira	5	100.0	0.0	0.0	17	11.9	e*

Gamma-GT

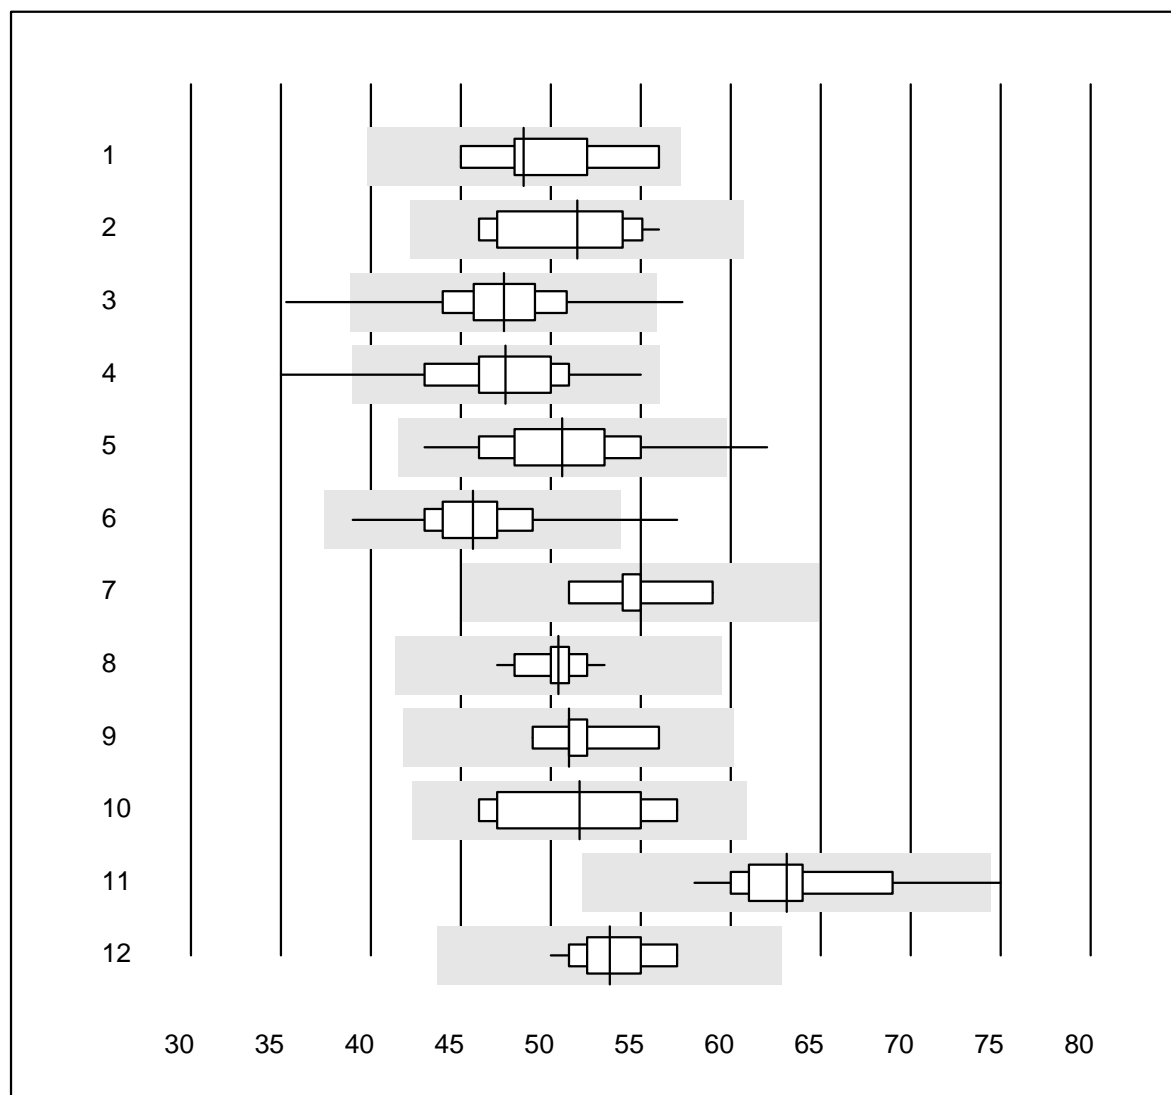


Tolérance QUALAB : 18 %

Gamma-GT (U/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 IFCC	6	100.0	0.0	0.0	49	7.7	e*
2 Cobas	16	100.0	0.0	0.0	51	6.9	e
3 Reflotron	827	98.3	0.6	1.1	47	5.8	e
4 Fuji Dri-Chem	778	99.1	0.4	0.5	47	6.5	e
5 Spotchem/Ready	127	96.8	1.6	1.6	51	6.8	e
6 Spotchem D-Concept	186	98.4	1.1	0.5	46	5.8	e
7 IFCC Beckmann	9	100.0	0.0	0.0	55	4.0	e
8 Piccolo	32	100.0	0.0	0.0	50	3.2	e
9 Skyla	5	100.0	0.0	0.0	51	5.0	e*
10 Abx Mira	9	88.9	0.0	11.1	52	8.0	e*
11 Hitachi S40/M40	19	94.7	5.3	0.0	63	6.3	e
12 Autolyser/DiaSys	14	100.0	0.0	0.0	53	4.0	e

Glucose

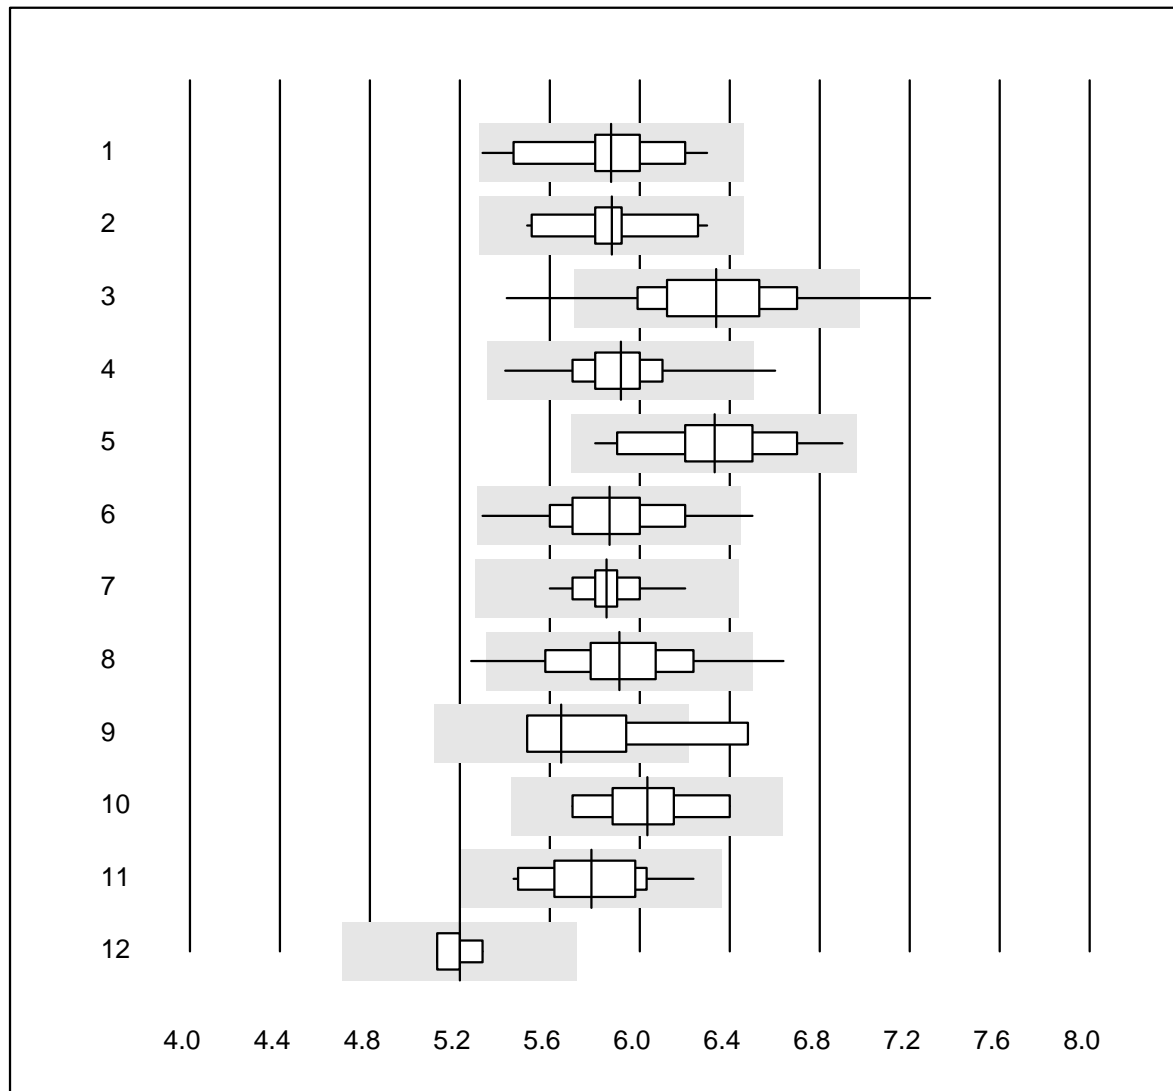


Tolérance QUALAB : 10 %

Glucose (mmol/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	27	100.0	0.0	0.0	5.9	4.1	e
2	Cobas	16	100.0	0.0	0.0	5.9	3.8	e
3	Reflotron	832	94.6	4.1	1.3	6.3	4.7	e
4	Fuji Dri-Chem	736	98.7	0.3	1.0	5.9	2.4	e
5	Spotchem/Ready	115	98.3	0.0	1.7	6.3	4.3	e
6	Spotchem D-Concept	174	97.7	1.7	0.6	5.9	4.1	e
7	Piccolo	41	92.7	0.0	7.3	5.9	1.8	e
8	Cholestech LDX	146	93.2	2.7	4.1	5.9	4.3	e
9	Abx Mira	9	77.8	11.1	11.1	5.7	5.8	e*
10	Hitachi S40/M40	19	100.0	0.0	0.0	6.0	3.7	e
11	Autolyser/DiaSys	14	100.0	0.0	0.0	5.8	4.0	e
12	iStat Chem8	5	100.0	0.0	0.0	5.2	1.6	e

Glucose

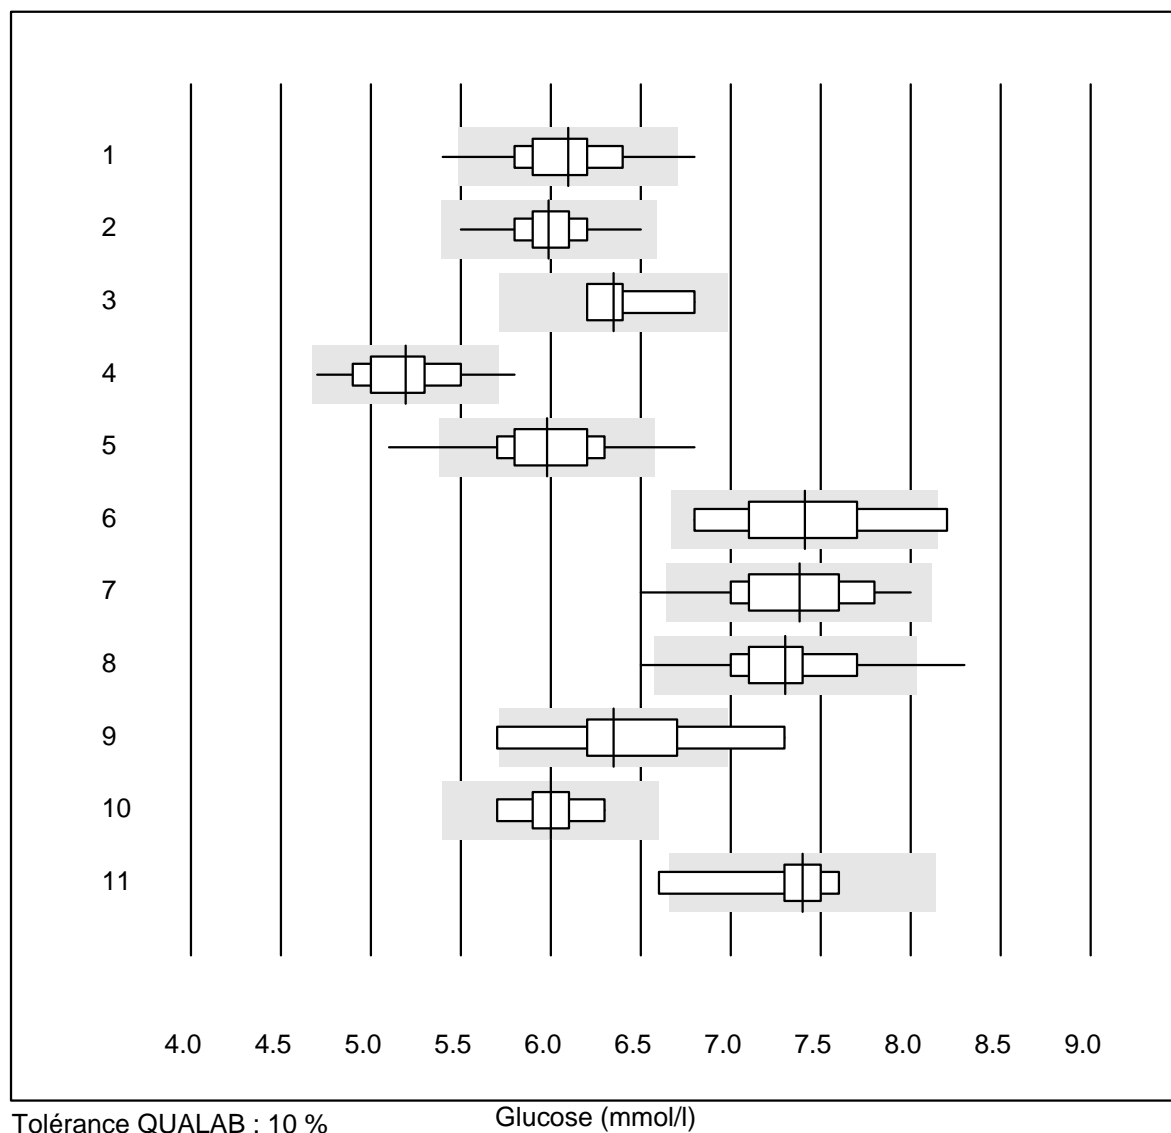


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Accu-Chek Aviva	413	96.1	1.5	2.4	6.1	3.7	e
2	Accu-Chek Inform 2	384	99.7	0.0	0.3	6.0	2.8	e
3	Accu-Chek Mobile	4	100.0	0.0	0.0	6.4	4.1	e*
4	Bayer Contour 2 (5s)	44	88.7	6.8	4.5	5.2	5.0	e
5	Contour XT/NEXT	1141	94.3	3.9	1.8	6.0	4.5	e
6	Glucocard	11	72.7	18.2	9.1	7.4	6.5	e*
7	Hemocue 201+ P-equiv	87	94.3	2.3	3.4	7.4	4.4	e
8	Hemocue 201RT P-equiv	50	90.0	6.0	4.0	7.3	4.4	e
9	FreeStyle Precision	8	62.5	37.5	0.0	6.4	7.7	e*
10	Freestyle Freedom li	9	100.0	0.0	0.0	6.0	3.5	e
11	Sanofi BG Star	6	66.6	16.7	16.7	7.4	5.6	e*

Glucose

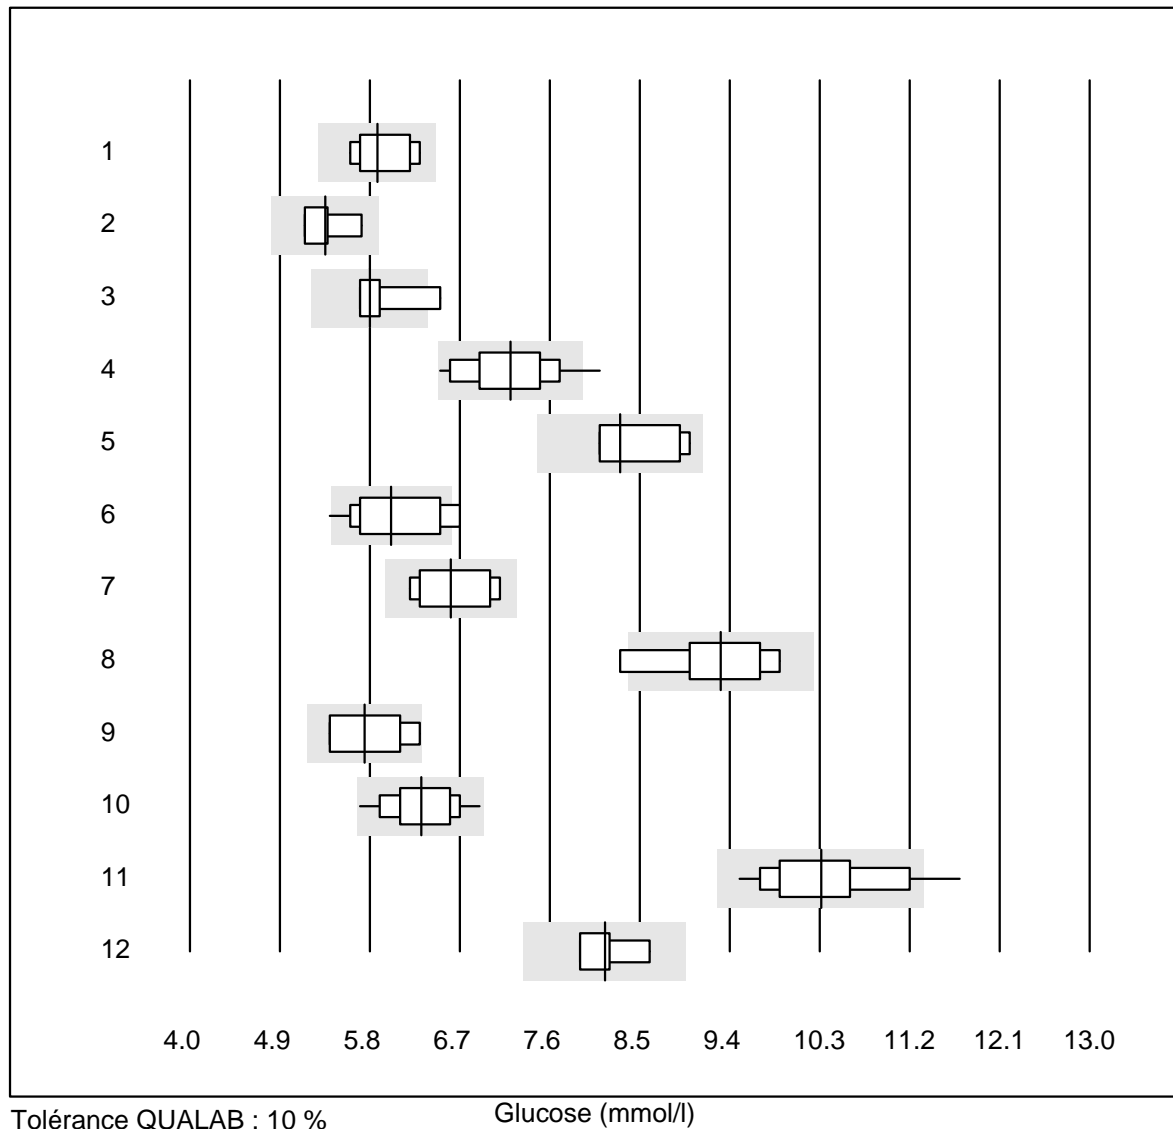

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Skyla	6	100.0	0.0	0.0	5.9	4.8	e*
2 Lange	4	100.0	0.0	0.0	5.4	4.5	e*
3 Bayer Elite	4	75.0	25.0	0.0	5.8	6.4	e*
4 Hemocue 201+ (alt)	46	91.3	2.2	6.5	7.2	5.8	e
5 OneTouch Ultra	5	100.0	0.0	0.0	8.3	5.2	e*
6 OneTouch Verio	26	80.8	19.2	0.0	6.0	7.4	e*
7 Contour (15s)	10	100.0	0.0	0.0	6.6	5.3	e*
8 Healthpro	14	78.6	14.3	7.1	9.3	6.0	e*
9 Mylife UNIO	8	100.0	0.0	0.0	5.8	6.2	e*
10 mylife Pura	61	86.9	0.0	13.1	6.3	5.1	e
11 Omnitest	17	82.3	5.9	11.8	10.3	5.6	e*
12 Alpha Check	4	100.0	0.0	0.0	8.2	3.6	e*

Acide urique

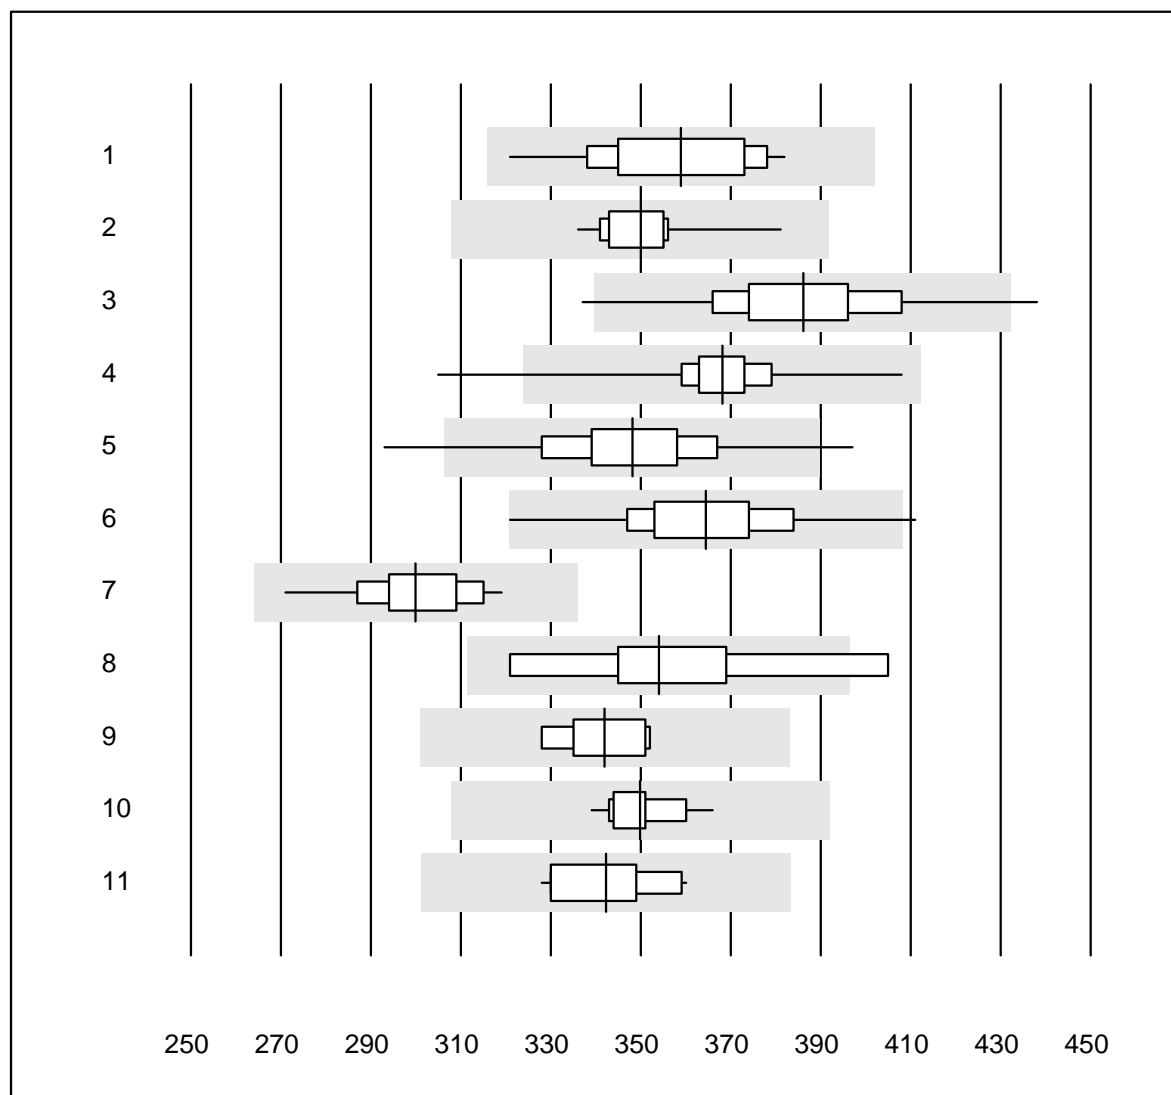


Tolérance QUALAB : 12 %

Acide urique (µmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	23	100.0	0.0	0.0	359	4.5	e
2	Cobas	11	100.0	0.0	0.0	350	3.4	e
3	Reflotron	724	98.2	0.7	1.1	386	4.3	e
4	Fuji Dri-Chem	738	98.7	0.1	1.2	368	2.4	e
5	Spotchem/Ready	106	97.2	2.8	0.0	348	4.8	e
6	Spotchem D-Concept	173	98.8	0.6	0.6	364	4.2	e
7	Piccolo	27	100.0	0.0	0.0	300	3.6	e
8	Skyla	6	83.3	16.7	0.0	354	7.8	e*
9	Abx Mira	8	87.5	0.0	12.5	342	2.6	e
10	Hitachi S40/M40	17	100.0	0.0	0.0	350	2.0	e
11	Autolyser/DiaSys	13	92.3	0.0	7.7	342	3.3	e

Urée

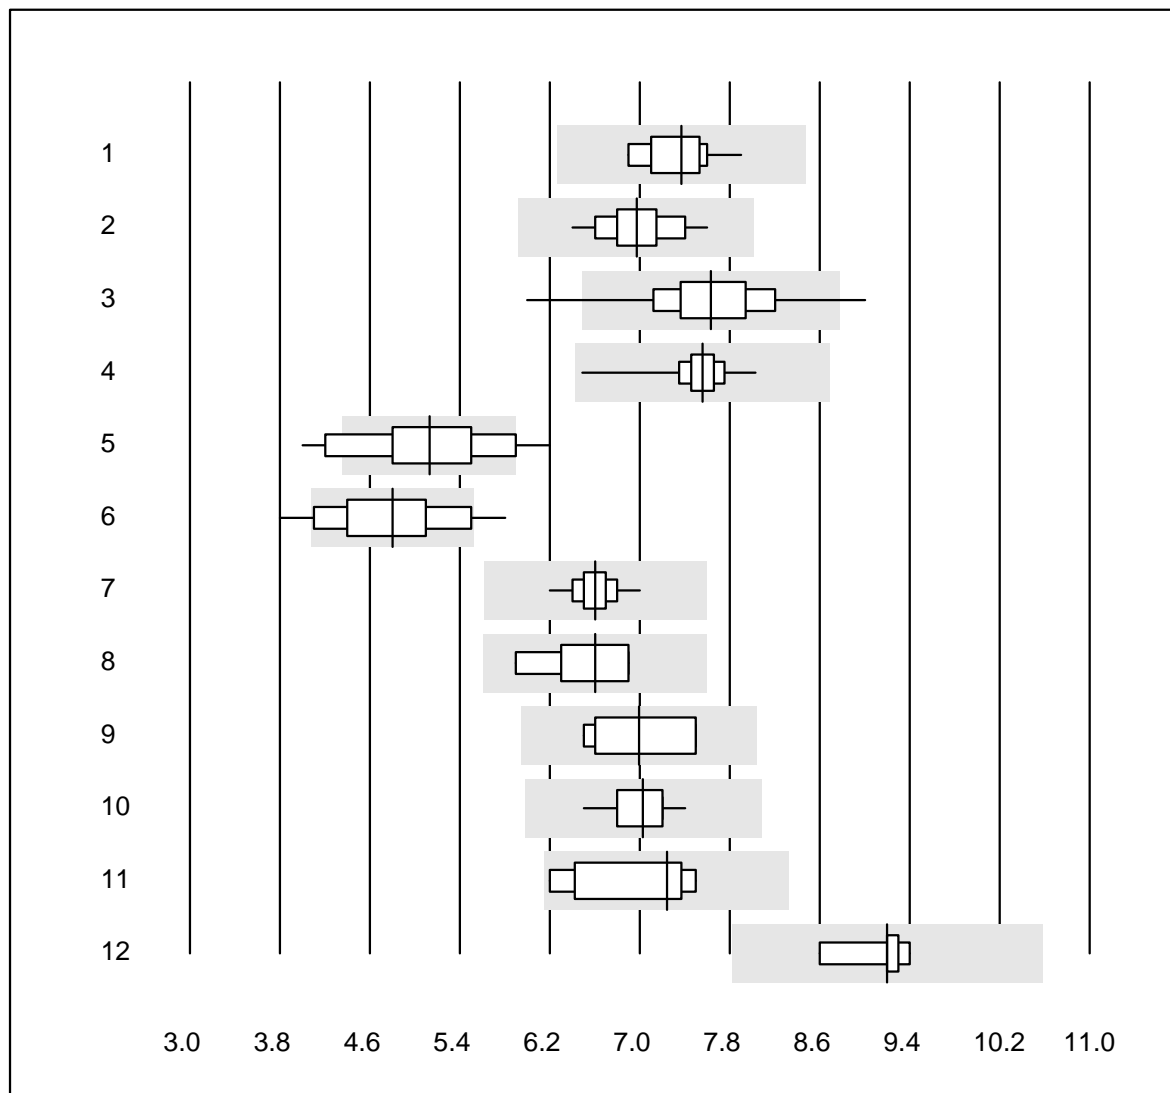


Tolérance QUALAB : 15 %

Urée (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	20	100.0	0.0	0.0	7.4	3.9	e
2	Cobas	15	100.0	0.0	0.0	7.0	4.3	e
3	Reflotron	327	95.5	2.1	2.4	7.6	6.0	e
4	Fuji Dri-Chem	448	99.1	0.0	0.9	7.6	2.2	e
5	Spotchem/Ready	71	62.0	22.5	15.5	5.1	11.1	e
6	Spotchem D-Concept	107	69.1	15.0	15.9	4.8	10.9	e
7	Piccolo	38	100.0	0.0	0.0	6.6	2.5	e
8	Skyla	6	100.0	0.0	0.0	6.6	5.9	e*
9	Abx Mira	6	100.0	0.0	0.0	7.0	6.1	e*
10	Hitachi S40/M40	13	92.3	0.0	7.7	7.0	3.5	e
11	Autolyser/DiaSys	7	100.0	0.0	0.0	7.2	7.7	e*
12	iStat Chem8	6	100.0	0.0	0.0	9.2	3.1	e

Potassium

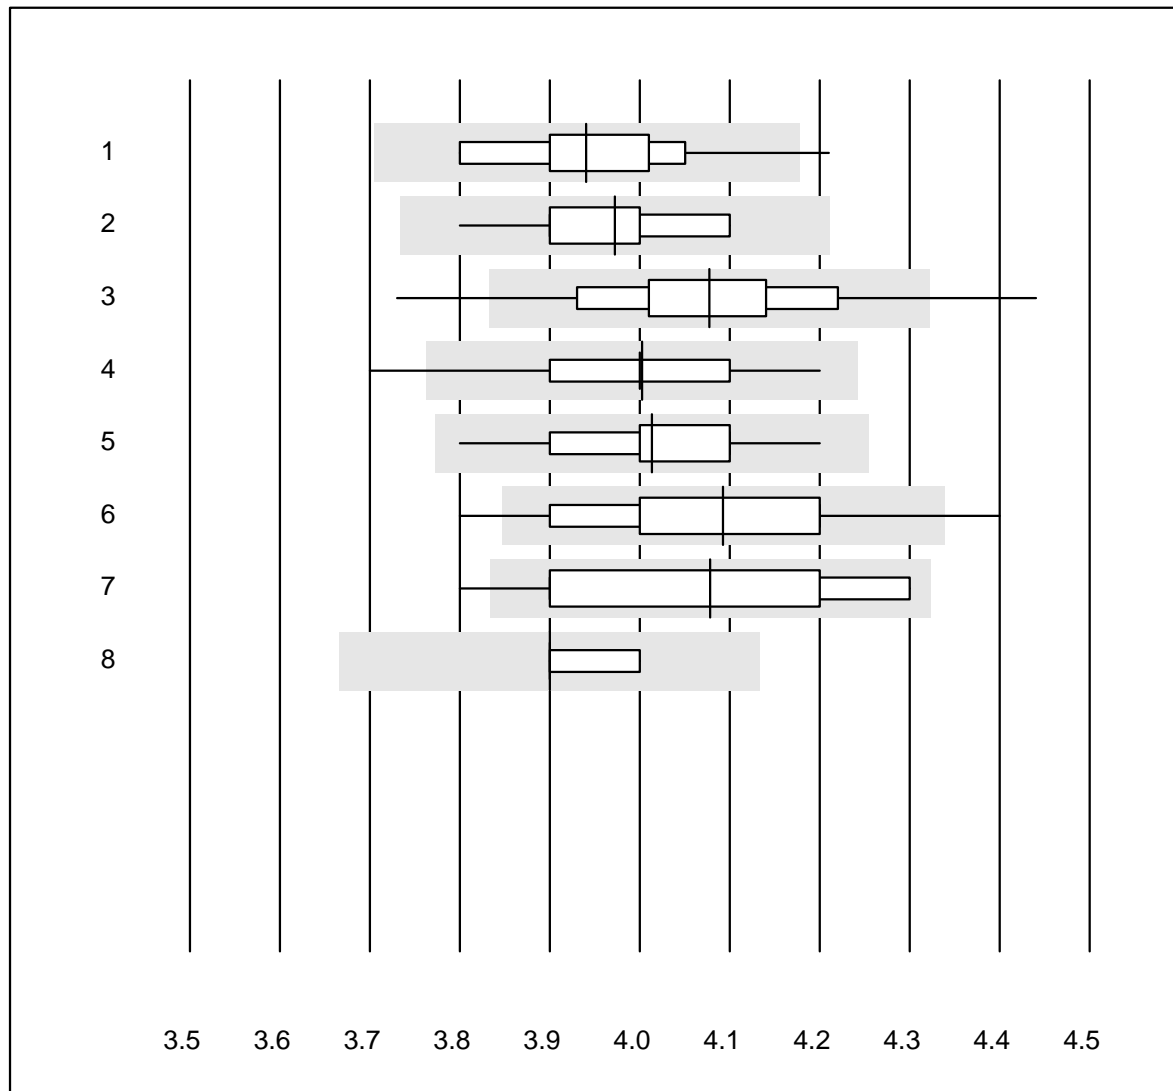


Tolérance QUALAB : 6 %

Potassium (mmol/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	ISE	32	93.8	3.1	3.1	3.94	2.6	e
2	Cobas	17	100.0	0.0	0.0	3.97	2.0	e
3	Reflotron	747	92.5	5.1	2.4	4.08	2.9	e
4	Fuji Dri-Chem	776	97.6	0.9	1.5	4.00	2.0	e
5	Spotchem D-Concept	175	98.3	0.0	1.7	4.01	2.2	e
6	Spotchem EL-SE 1520	115	94.0	1.7	4.3	4.09	2.9	e
7	Piccolo	26	80.8	7.7	11.5	4.08	4.2	e*
8	iStat Chem8	6	100.0	0.0	0.0	3.90	1.0	e

Créatinine

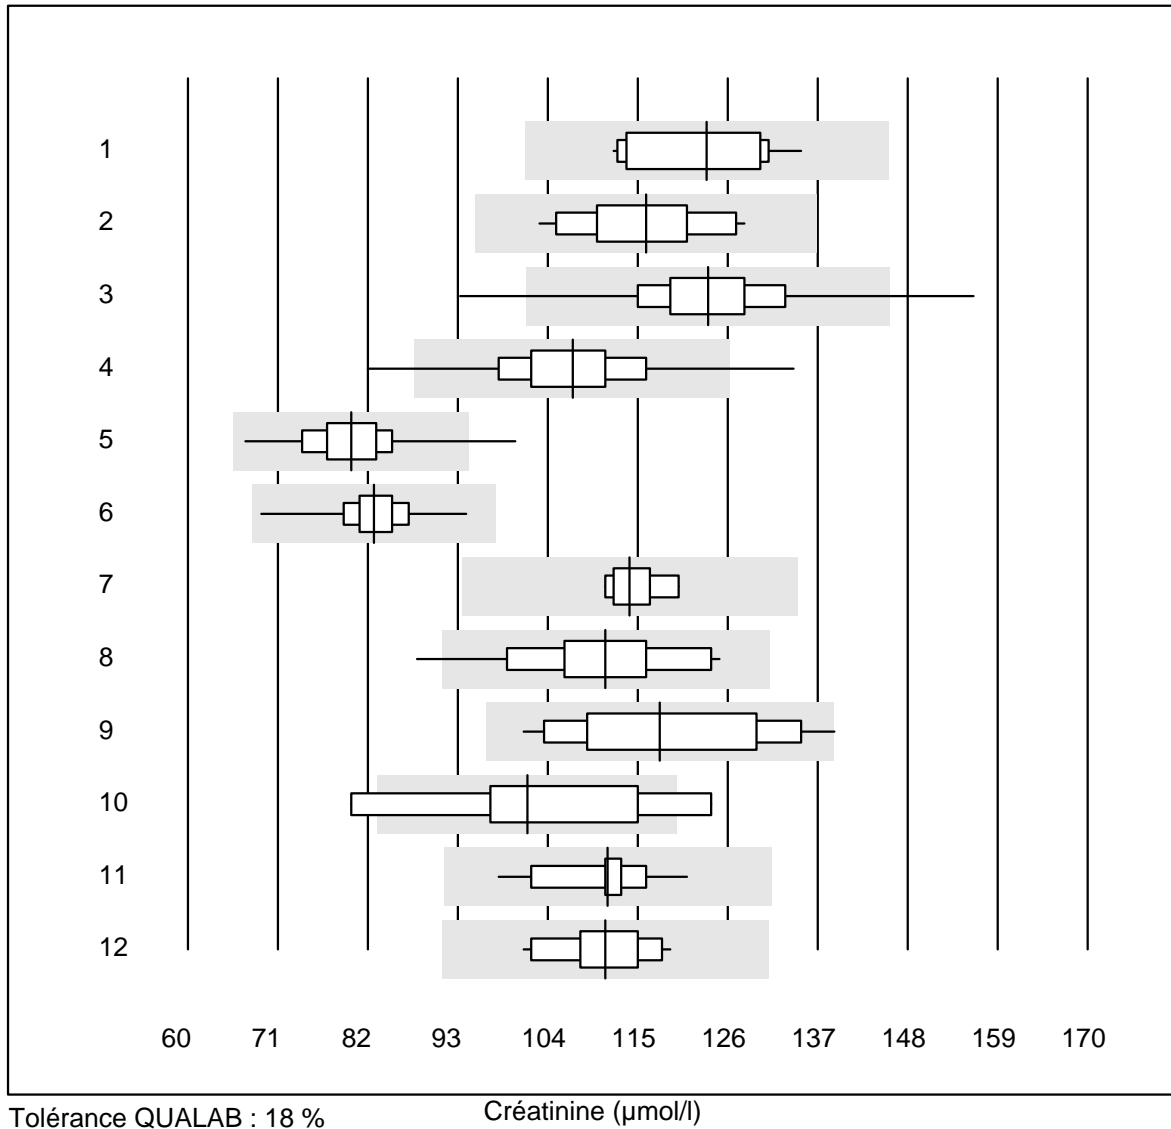

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	15	93.3	0.0	6.7	123	6.4	e
2	Cobas	17	100.0	0.0	0.0	116	6.5	e
3	Reflotron	936	97.2	1.5	1.3	124	6.1	e
4	Fuji Dri-Chem	803	95.3	1.2	3.5	107	6.7	e
5	Spotchem/Ready	127	94.5	0.8	4.7	80	6.2	e
6	Spotchem D-Concept	178	98.3	0.0	1.7	83	4.4	e
7	Enzymatisch	7	100.0	0.0	0.0	114	2.7	e
8	Piccolo	39	89.7	7.7	2.6	111	8.4	e
9	Abx Mira	11	90.9	9.1	0.0	118	10.8	e*
10	Skyla	8	62.5	37.5	0.0	102	14.6	e*
11	Hitachi S40/M40	18	94.4	0.0	5.6	111	4.6	e
12	Autolyser/DiaSys	14	100.0	0.0	0.0	111	4.9	e

Créatinine E

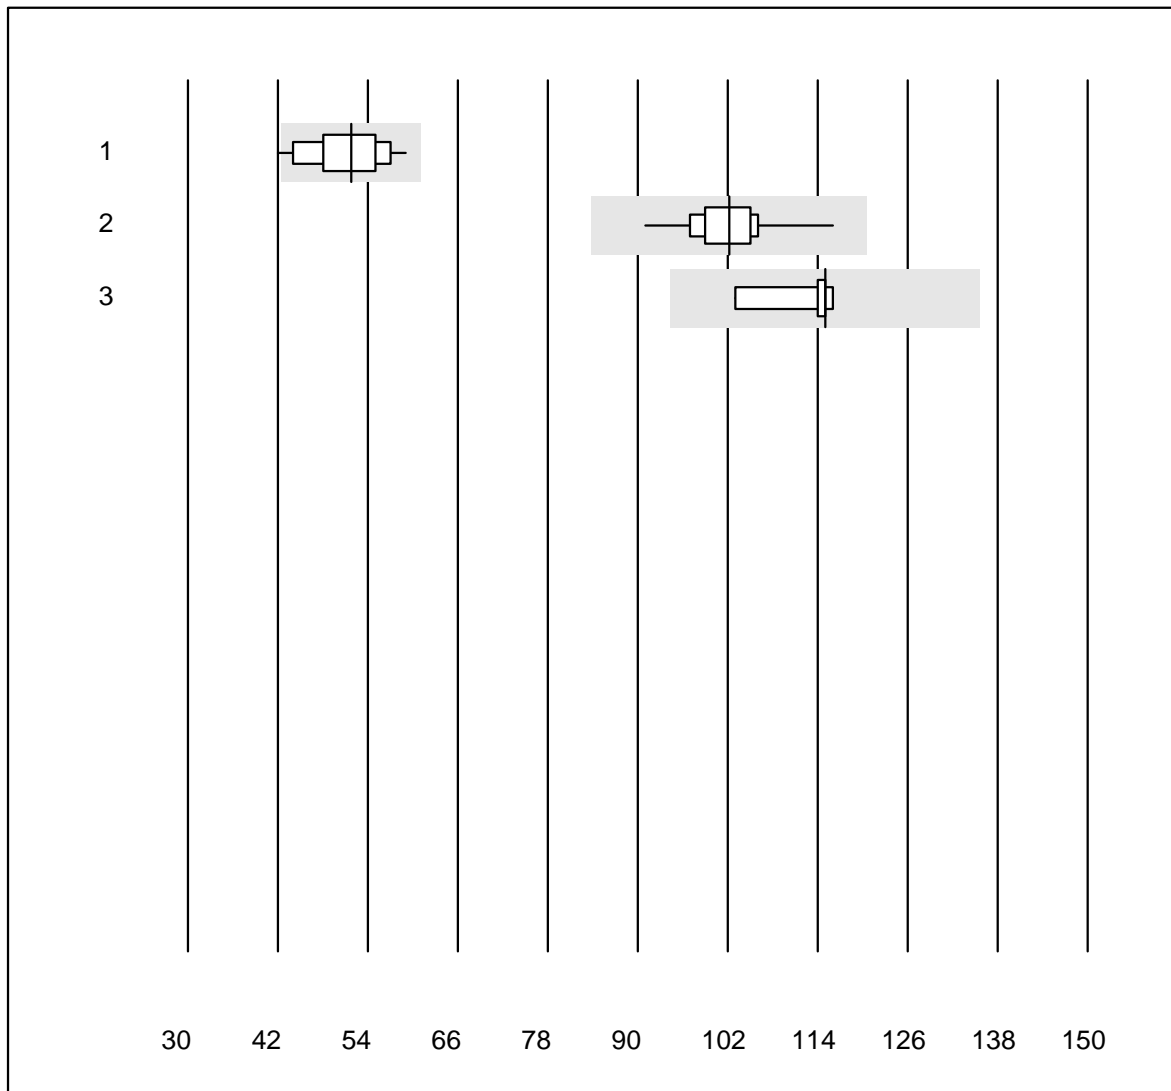


Tolérance QUALAB : 18 %

Créatinine E (µmol/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Statsensor i / Nova	37	89.2	8.1	2.7	52	9.4	e
2	iStat Chem8	11	100.0	0.0	0.0	102	6.1	e
3	ABL700/800	9	100.0	0.0	0.0	115	3.6	e

eGFR CKD-EPI

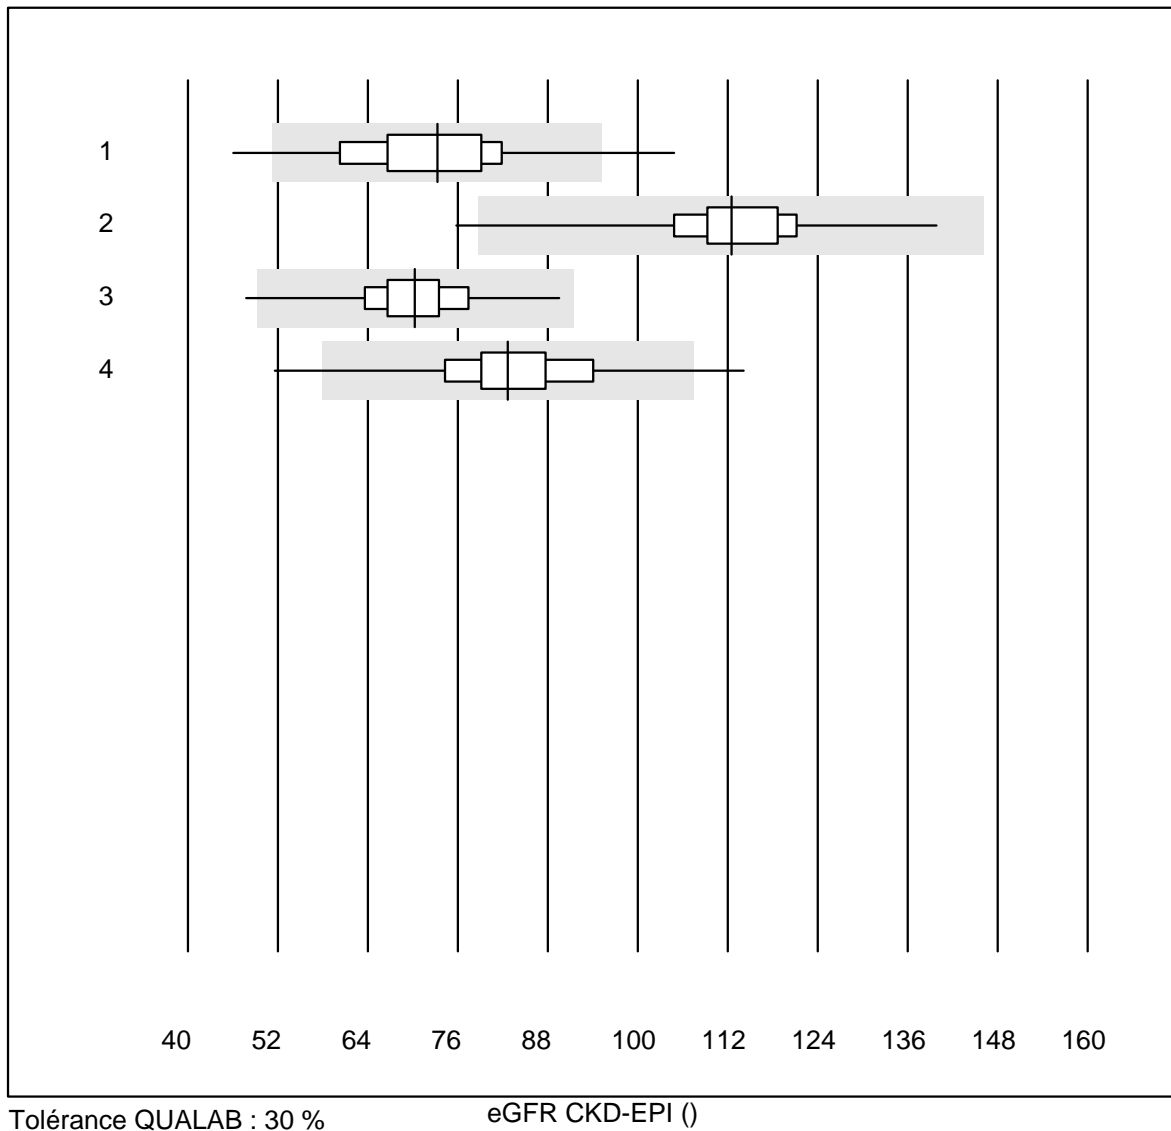


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	57	84.2	5.3	10.5	73	13.8	e
2	Spotchem/Ready	125	92.8	2.4	4.8	112	9.0	e
3	Reflotron	332	96.1	0.3	3.6	70	8.2	e
4	Fuji Dri-Chem	321	94.7	1.9	3.4	83	10.3	e

eGFR Cockcroft-Gault

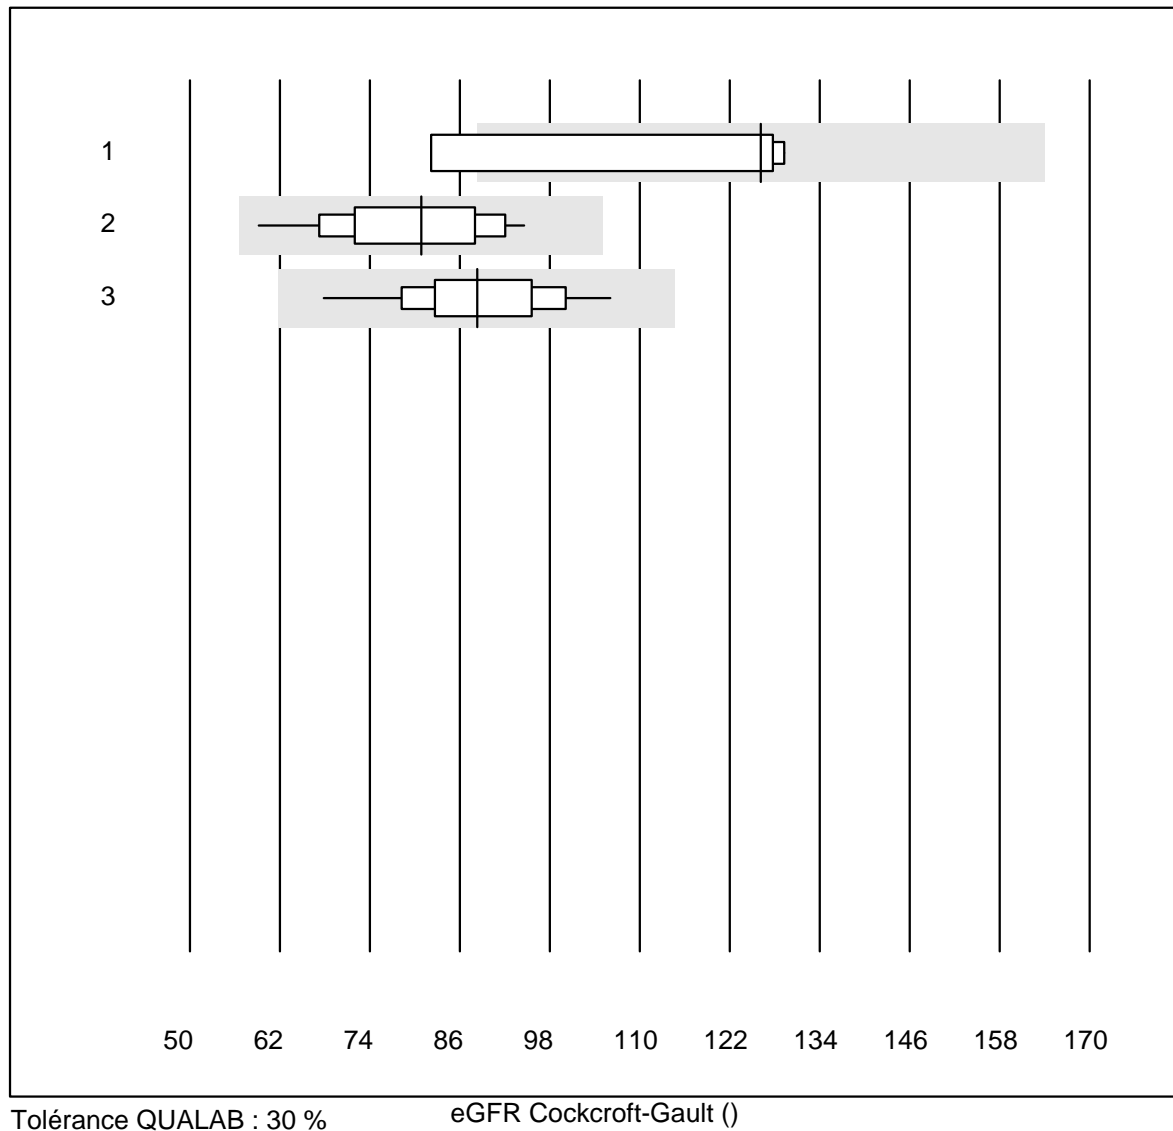

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Spotchem/Ready	4	75.0	25.0	0.0	126	19.5	e*
2	Reflotron	28	100.0	0.0	0.0	81	12.0	e
3	Fuji Dri-Chem	17	88.2	0.0	11.8	88	11.2	e

eGFR MDRD

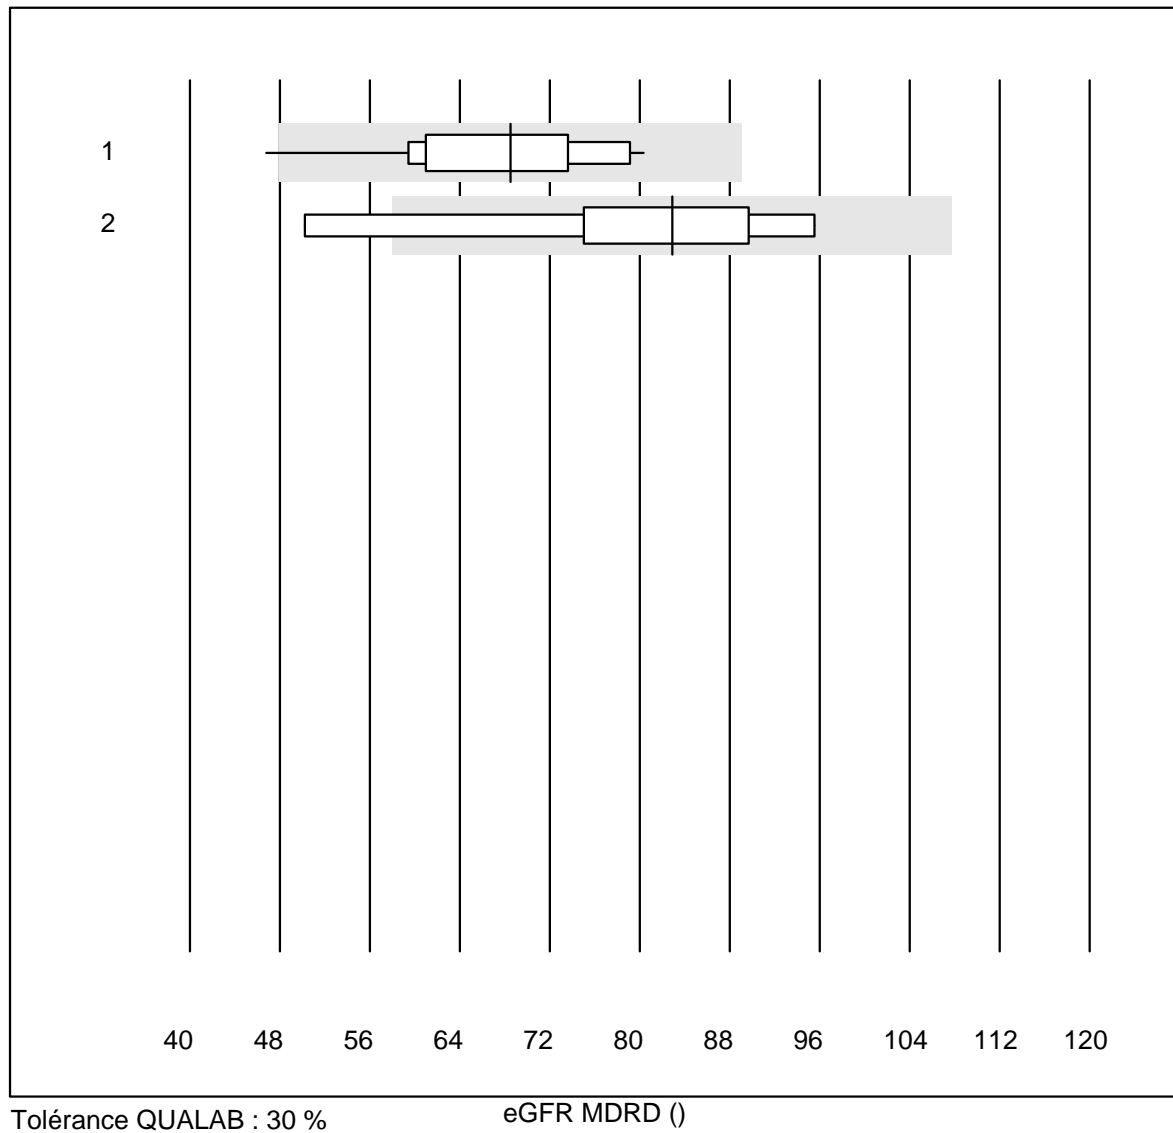


Tolérance QUALAB : 30 %

eGFR MDRD ()

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Reflotron	12	83.4	8.3	8.3	69	14.1	e*
2 Fuji Dri-Chem	6	83.3	16.7	0.0	83	20.0	e*

LDH

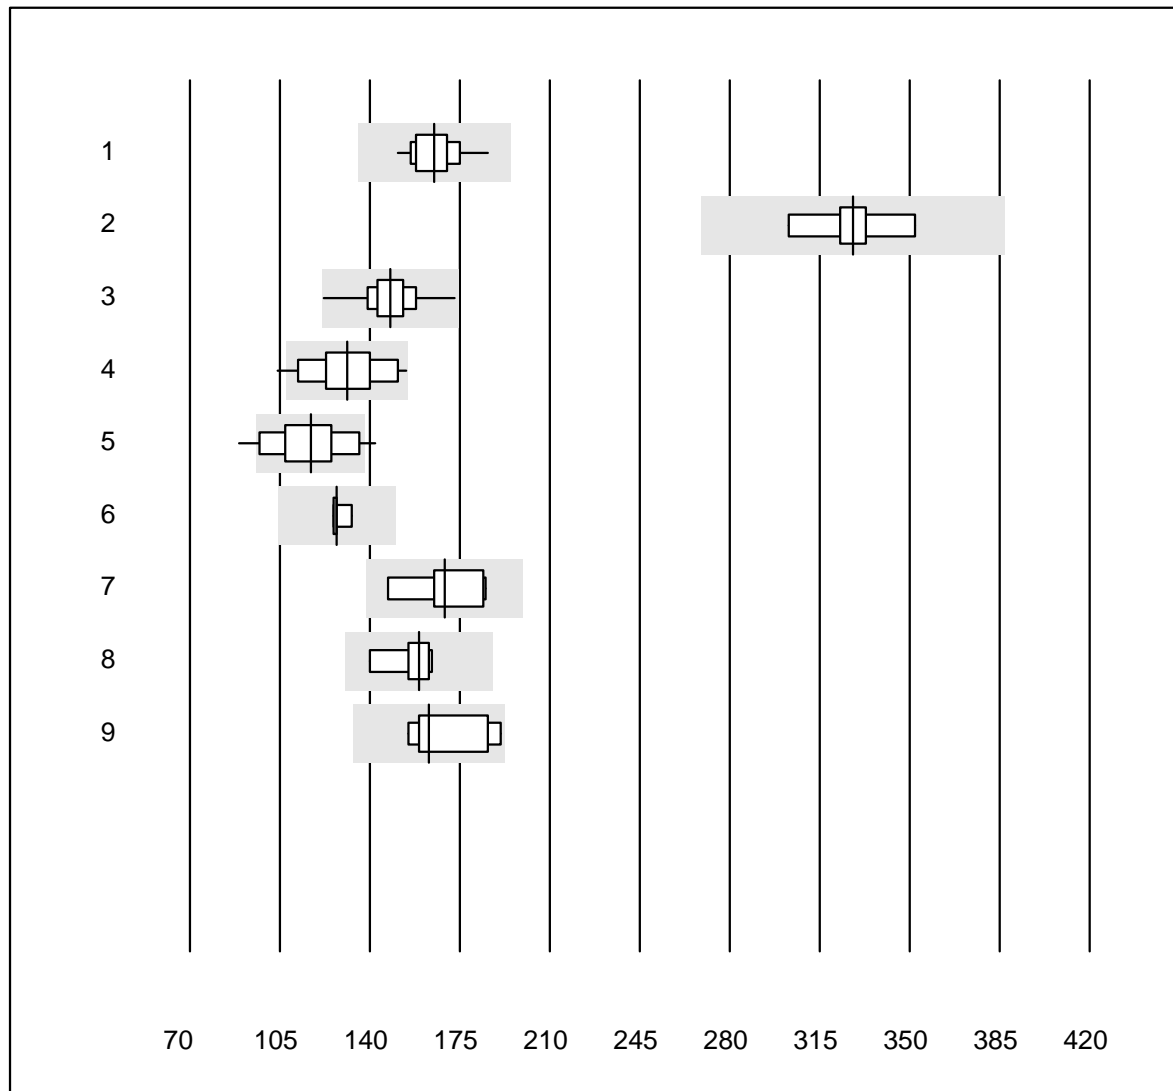


Tolérance QUALAB : 18 %

LDH (U/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 IFCC	21	100.0	0.0	0.0	165	5.8	e
2 Cobas	9	100.0	0.0	0.0	328	4.2	e
3 Fuji Dri-Chem	147	98.6	0.0	1.4	148	5.1	e
4 Spotchem/Ready	29	96.6	3.4	0.0	131	9.7	e
5 Spotchem D-Concept	40	80.0	12.5	7.5	117	11.8	e
6 Piccolo	4	100.0	0.0	0.0	127	2.5	e
7 Abx Mira	6	100.0	0.0	0.0	169	8.2	e*
8 Hitachi S40/M40	6	100.0	0.0	0.0	159	5.6	e*
9 Autolyser/DiaSys	7	100.0	0.0	0.0	163	8.7	e*

Magnésium

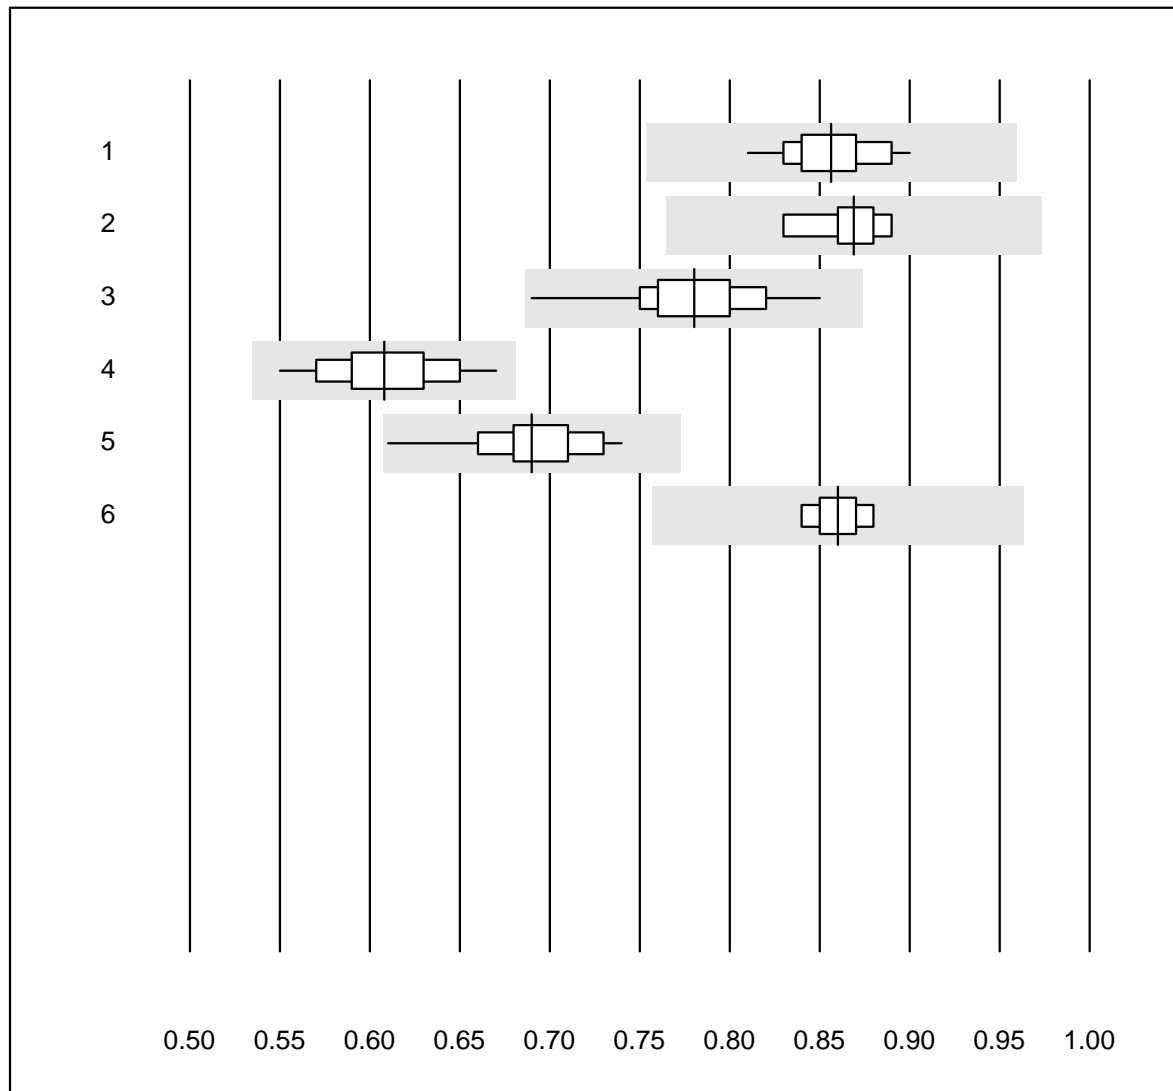


Tolérance QUALAB : 12 %

Magnésium (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	16	100.0	0.0	0.0	0.86	2.7	e
2	Cobas	10	100.0	0.0	0.0	0.87	2.6	e
3	Fuji Dri-Chem	119	98.3	0.0	1.7	0.78	3.8	e
4	Spotchem D-Concept	35	100.0	0.0	0.0	0.61	5.0	e
5	Spotchem/Ready	13	100.0	0.0	0.0	0.69	4.8	e
6	Piccolo	7	100.0	0.0	0.0	0.86	1.6	e

Sodium

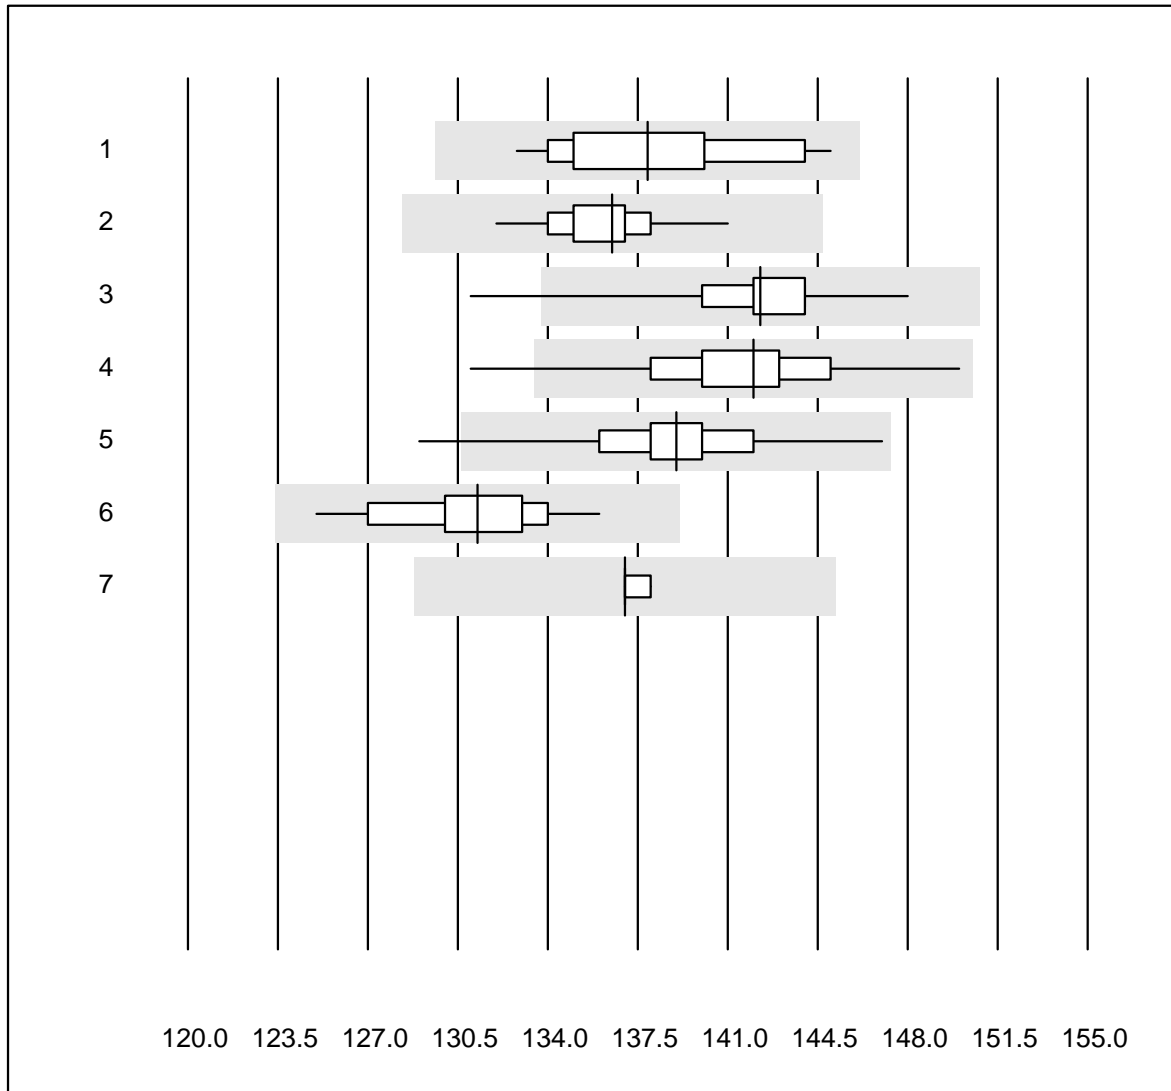


Tolérance QUALAB : 6 %

Sodium (mmol/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ISE	31	100.0	0.0	0.0	138	2.7	e
2 Cobas	16	100.0	0.0	0.0	137	1.5	e
3 Fuji Dri-Chem	721	98.2	0.7	1.1	142	1.5	e
4 Spotchem D-Concept	167	94.6	3.6	1.8	142	2.2	e
5 Spotchem EL-SE 1520	115	97.4	0.9	1.7	139	1.8	e
6 Piccolo	27	100.0	0.0	0.0	131	1.9	e
7 iStat Chem8	5	100.0	0.0	0.0	137	0.3	e

Phosphates

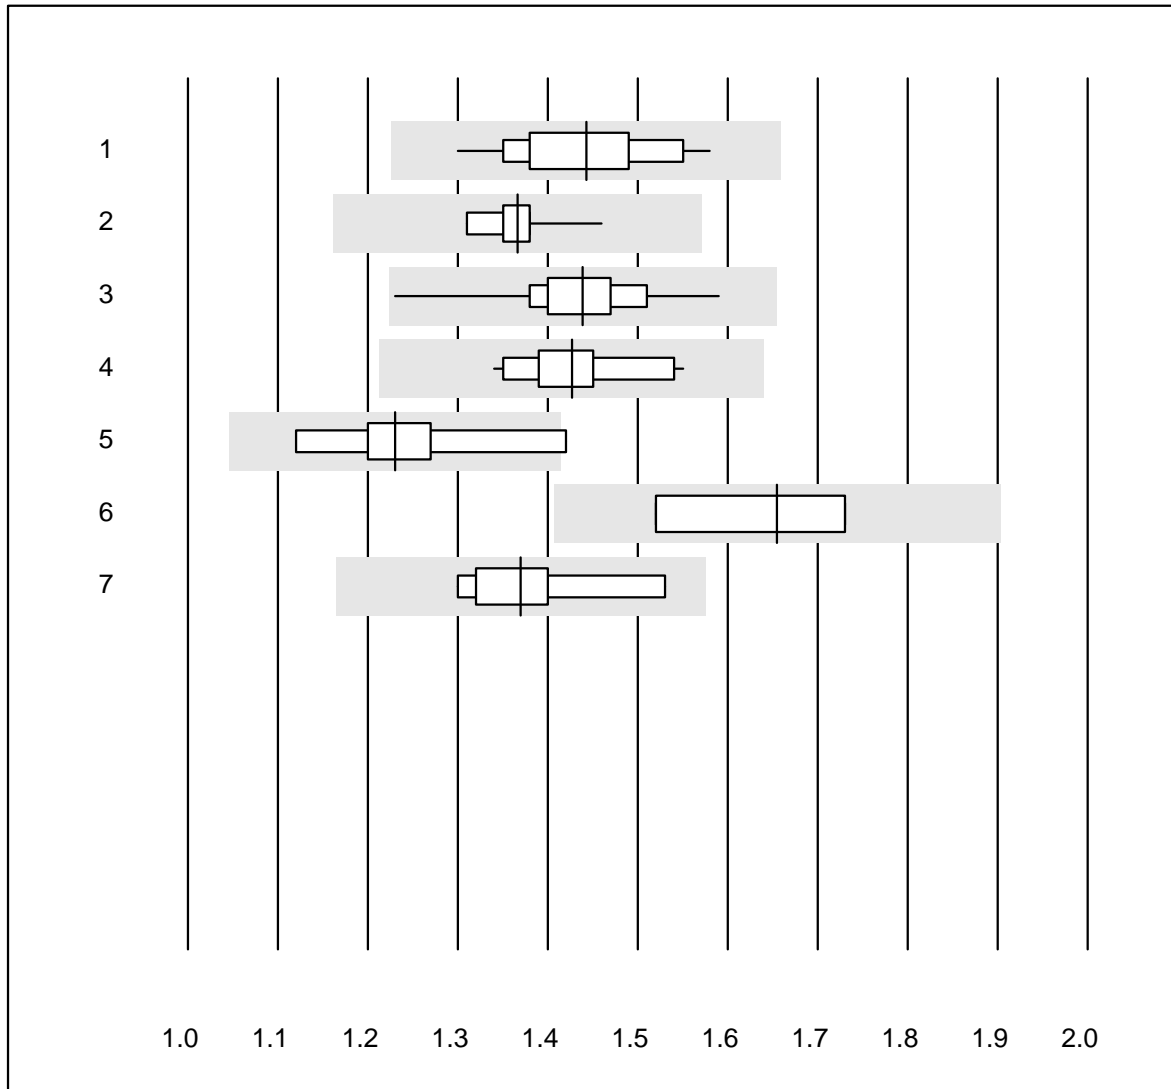


Tolérance QUALAB : 15 %

Phosphates (mmol/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	16	100.0	0.0	0.0	1.4	5.4	e
2	Cobas	10	100.0	0.0	0.0	1.4	2.8	e
3	Fuji Dri-Chem	82	97.6	0.0	2.4	1.4	4.3	e
4	Spotchem D-Concept	17	100.0	0.0	0.0	1.4	4.1	e
5	Spotchem/Ready	9	88.9	11.1	0.0	1.2	7.8	e*
6	Piccolo	4	75.0	0.0	25.0	1.7	6.7	e*
7	Abx Mira	5	100.0	0.0	0.0	1.4	6.6	e*

Protéine

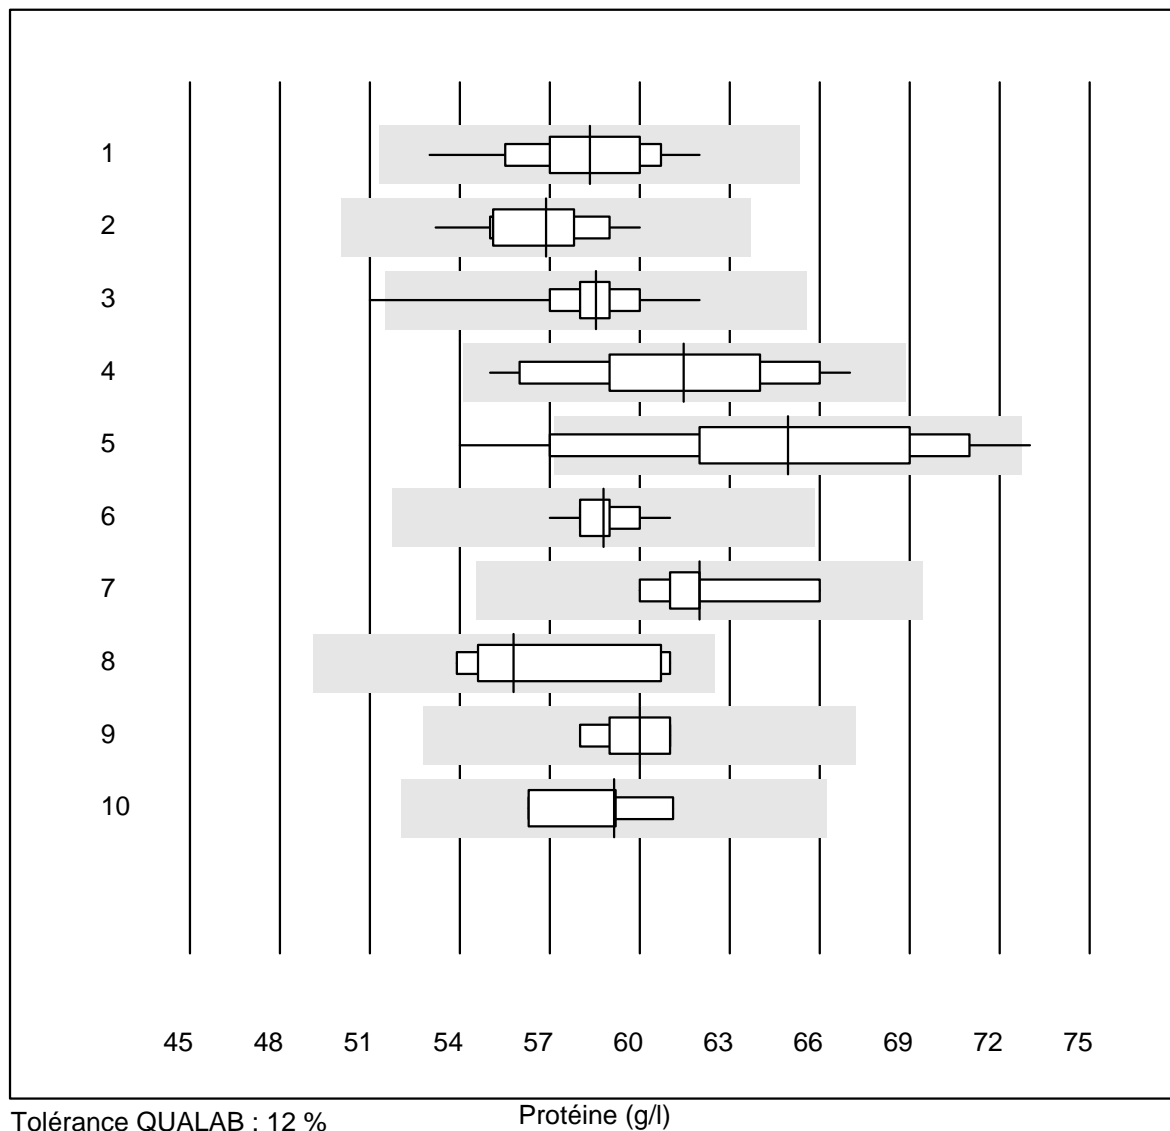

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	21	100.0	0.0	0.0	58.3	3.9	e
2	Cobas	12	100.0	0.0	0.0	56.9	3.3	e
3	Fuji Dri-Chem	180	98.3	0.6	1.1	58.5	2.4	e
4	Spotchem/Ready	33	100.0	0.0	0.0	61.5	5.8	e
5	Spotchem D-Concept	78	85.9	12.8	1.3	64.9	7.4	e
6	Piccolo	30	100.0	0.0	0.0	58.8	1.6	e
7	Skyla	6	100.0	0.0	0.0	62.0	3.3	e
8	Abx Mira	5	100.0	0.0	0.0	55.8	5.9	e*
9	Hitachi S40/M40	7	100.0	0.0	0.0	60.0	1.8	e
10	Autolyser/DiaSys	4	100.0	0.0	0.0	59.2	3.4	e*

Transaminase GOT/AST

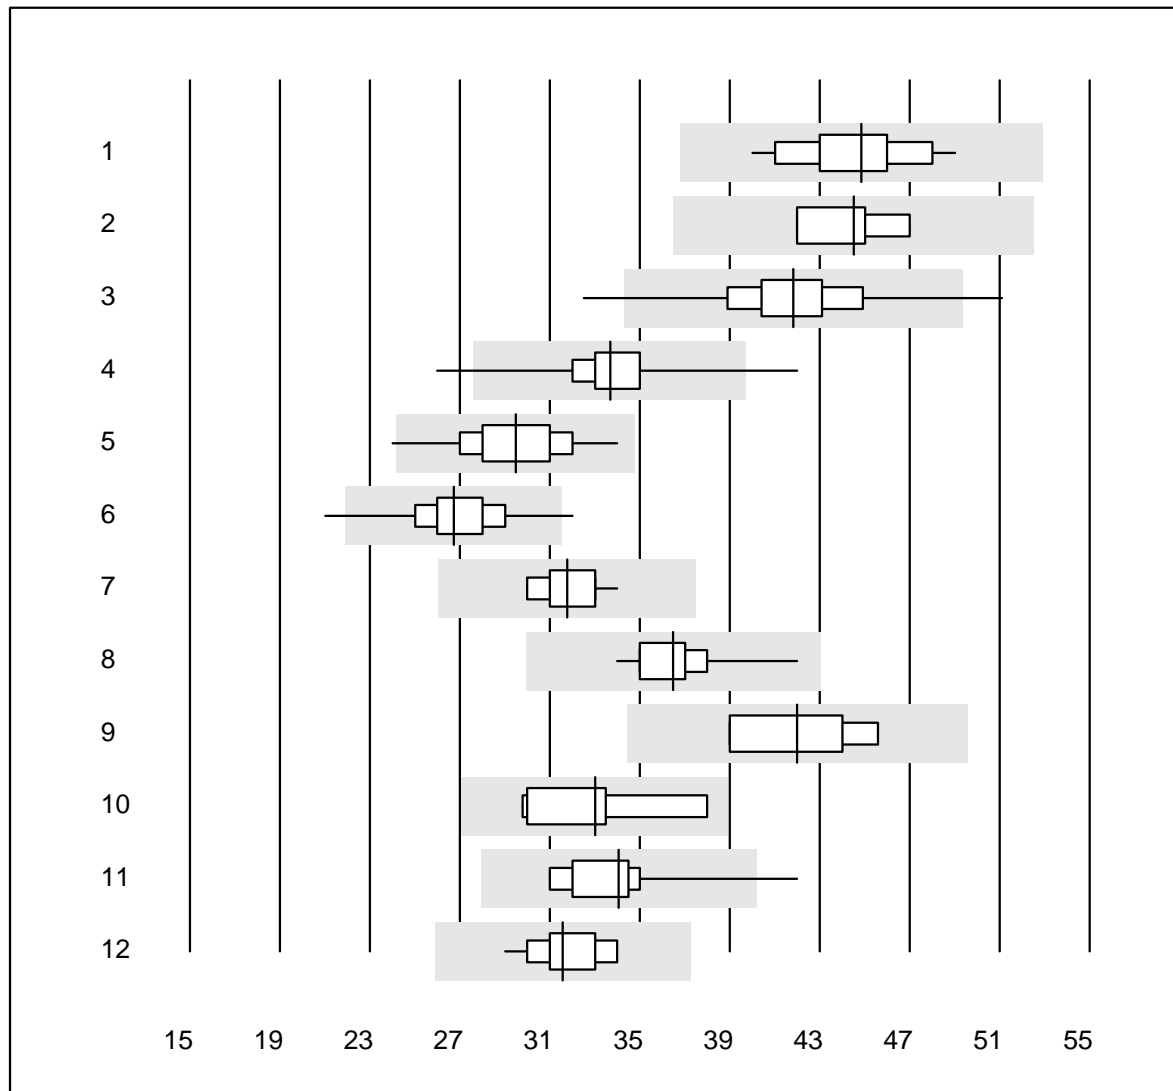


Tolérance QUALAB : 18 %

Transaminase GOT/AST (U/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	IFCC avec PP	20	100.0	0.0	0.0	45	5.1	e
2	Cobas	8	100.0	0.0	0.0	45	4.1	e
3	Reflotron	831	96.4	1.2	2.4	42	6.2	e
4	Fuji Dri-Chem	779	99.0	0.4	0.6	34	4.5	e
5	Spotchem/Ready	136	97.8	0.7	1.5	29	6.3	e
6	Spotchem D-Concept	181	98.9	1.1	0.0	27	6.3	e
7	IFCC sens PP	10	100.0	0.0	0.0	32	4.1	e
8	Piccolo	40	100.0	0.0	0.0	36	4.1	e
9	Skyla	8	100.0	0.0	0.0	42	6.6	e*
10	Abx Mira	9	88.9	0.0	11.1	33	8.9	e*
11	Hitachi S40/M40	20	95.0	5.0	0.0	34	6.8	e
12	Autolyser/DiaSys	14	100.0	0.0	0.0	32	4.6	e

Transaminase GPT/ALT

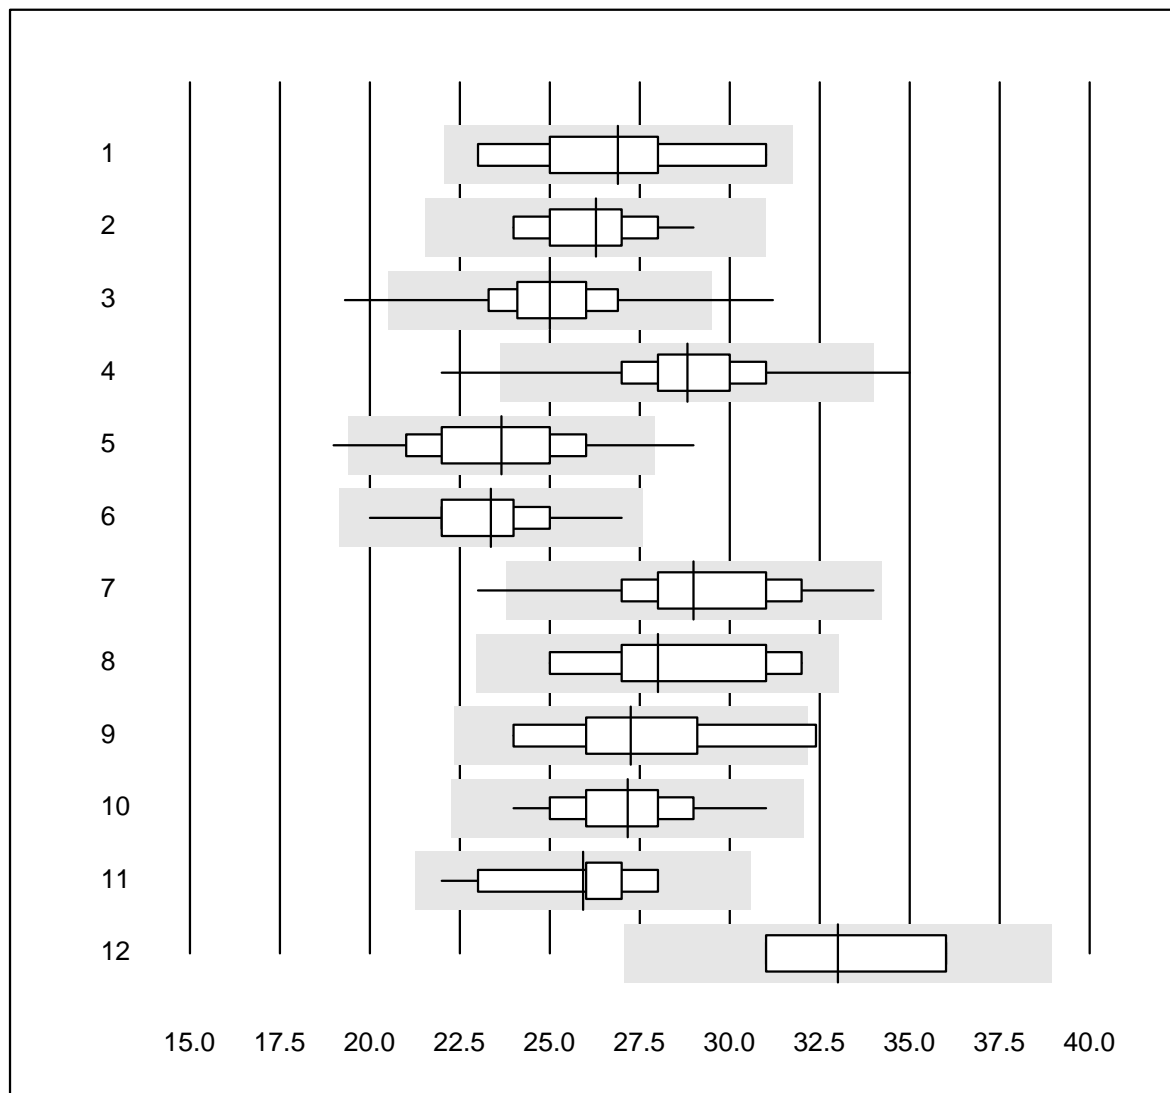


Tolérance QUALAB : 18 %

Transaminase GPT/ALT (U/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 IFCC avec PP	17	100.0	0.0	0.0	27	9.8	e*
2 Cobas	18	100.0	0.0	0.0	26	5.2	e
3 Reflotron	865	97.9	0.9	1.2	25	6.0	e
4 Fuji Dri-Chem	798	98.4	1.0	0.6	29	5.9	e
5 Spotchem/Ready	140	95.0	2.9	2.1	24	7.9	e
6 Spotchem D-Concept	186	100.0	0.0	0.0	23	6.1	e
7 Piccolo	41	97.6	2.4	0.0	29	8.4	e
8 Skyla	8	87.5	0.0	12.5	28	8.5	e*
9 Abx Mira	8	75.0	12.5	12.5	27	9.6	e*
10 Hitachi S40/M40	20	90.0	0.0	10.0	27	6.1	e
11 Autolyser/DiaSys	14	100.0	0.0	0.0	26	6.5	e
12 Autres méthodes	4	75.0	0.0	25.0	33	7.8	a

Triglycérides

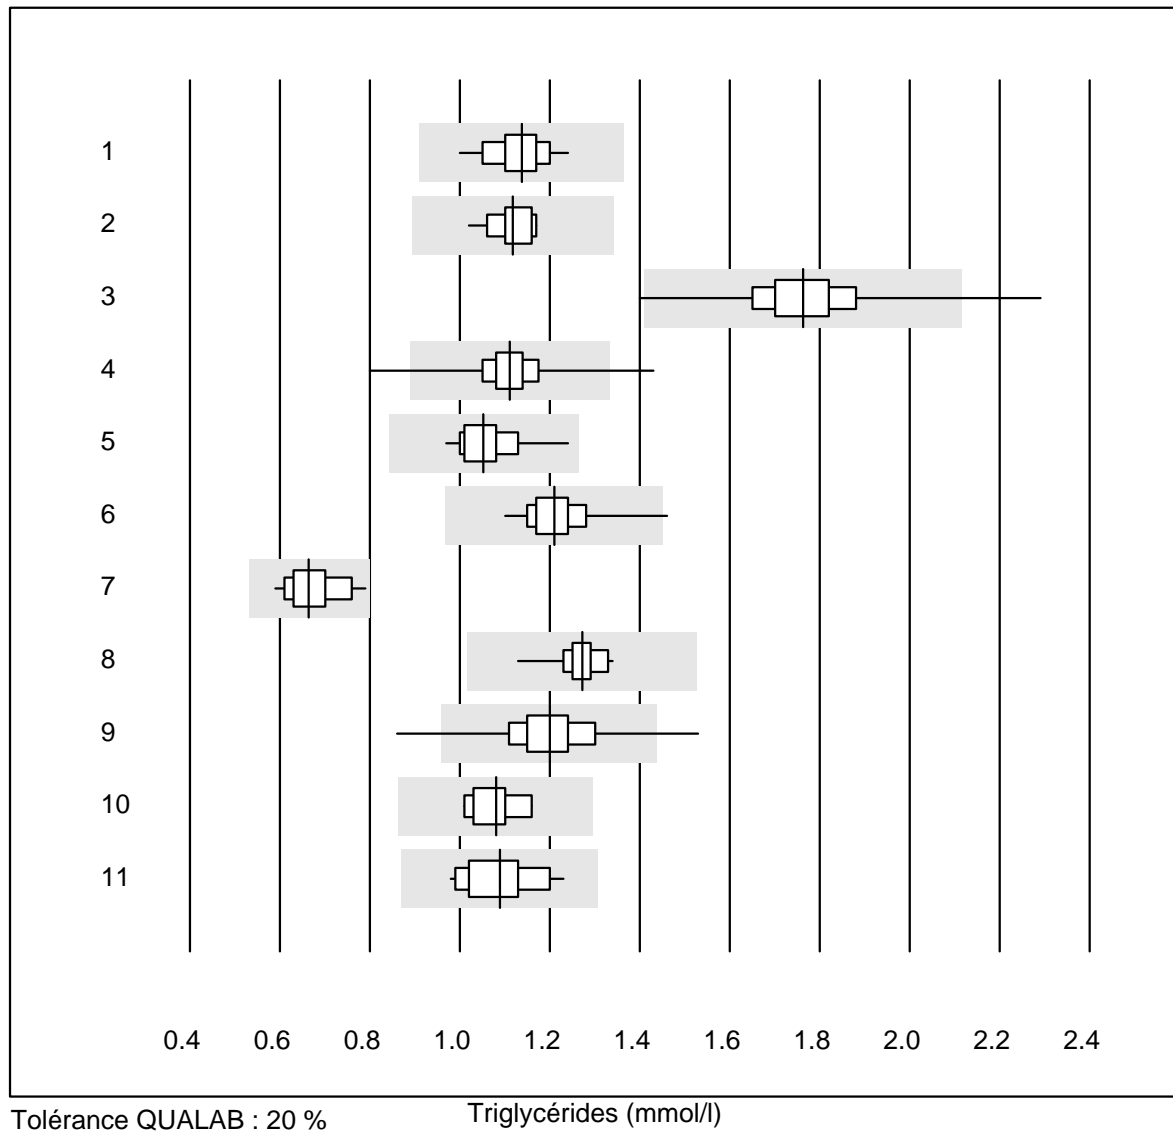


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	20	100.0	0.0	0.0	1.14	5.4	e
2	Cobas	17	100.0	0.0	0.0	1.12	3.8	e
3	Reflotron	590	97.6	1.0	1.4	1.76	5.7	e
4	Fuji Dri-Chem	702	97.8	0.9	1.3	1.11	5.1	e
5	Spotchem/Ready	119	97.5	0.0	2.5	1.05	5.2	e
6	Spotchem D-Concept	164	98.8	0.6	0.6	1.21	4.7	e
7	Hitachi S40/M40	15	100.0	0.0	0.0	0.66	8.3	e
8	Piccolo	20	100.0	0.0	0.0	1.27	3.8	e
9	Cholestech LDX	182	98.4	1.6	0.0	1.20	6.9	e
10	Abx Mira	9	88.9	0.0	11.1	1.08	4.5	e
11	Autolyser/DiaSys	13	100.0	0.0	0.0	1.09	7.6	e

LDL Cholesterin

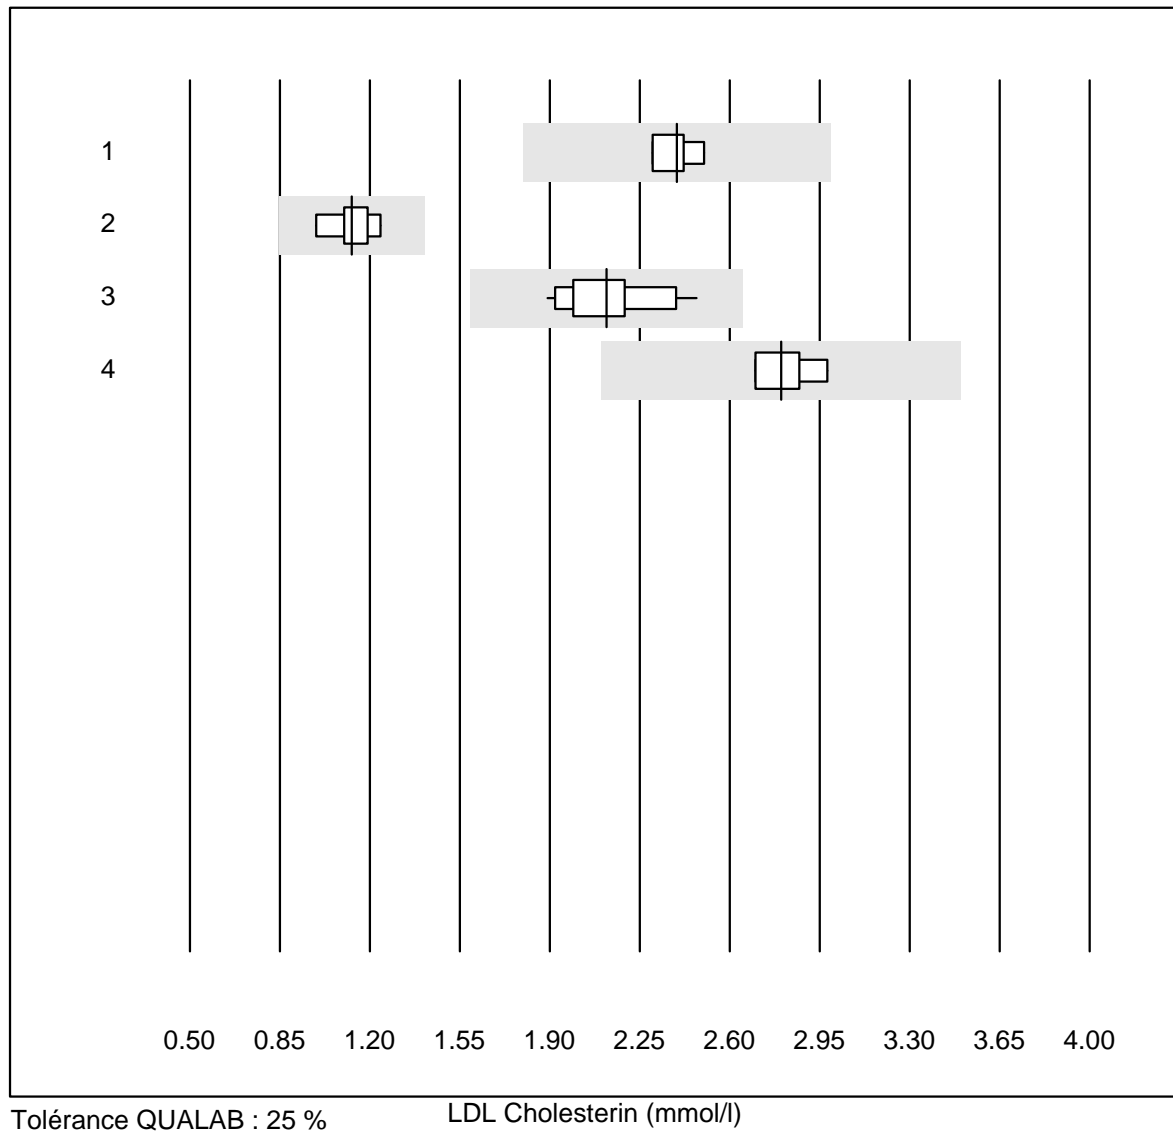


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Roche, Cobas	4	100.0	0.0	0.0	2.4	3.5	e
2 Hitachi S40/M40	7	100.0	0.0	0.0	1.1	6.9	e
3 Autolyser/DiaSys	13	100.0	0.0	0.0	2.1	8.1	e
4 Beckman	5	100.0	0.0	0.0	2.8	4.2	a

Lithium

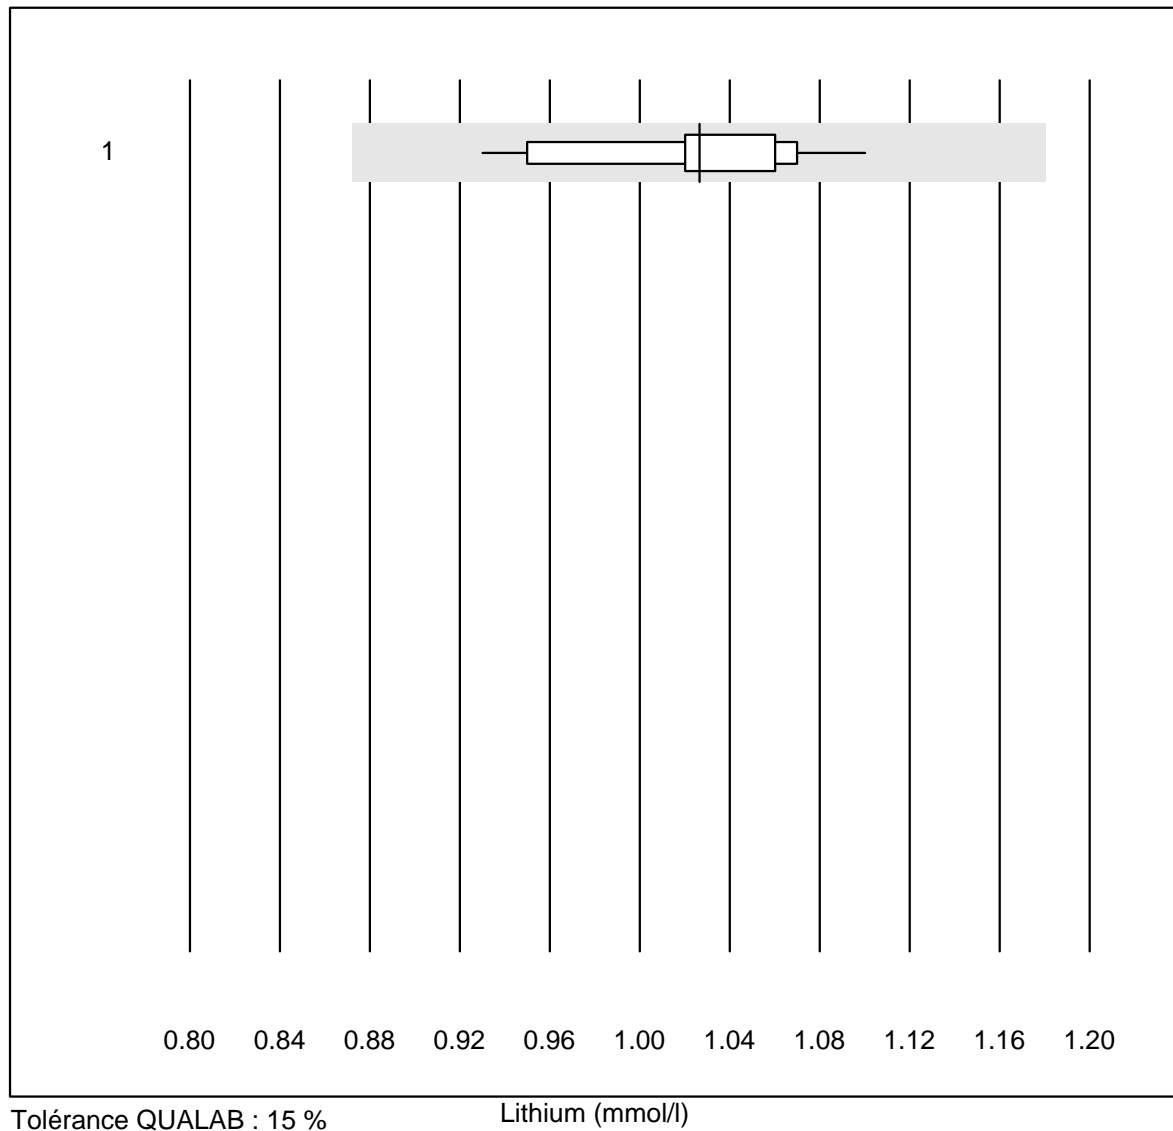


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 toutes les méthodes	14	100.0	0.0	0.0	1.03	4.5	e

Laktat

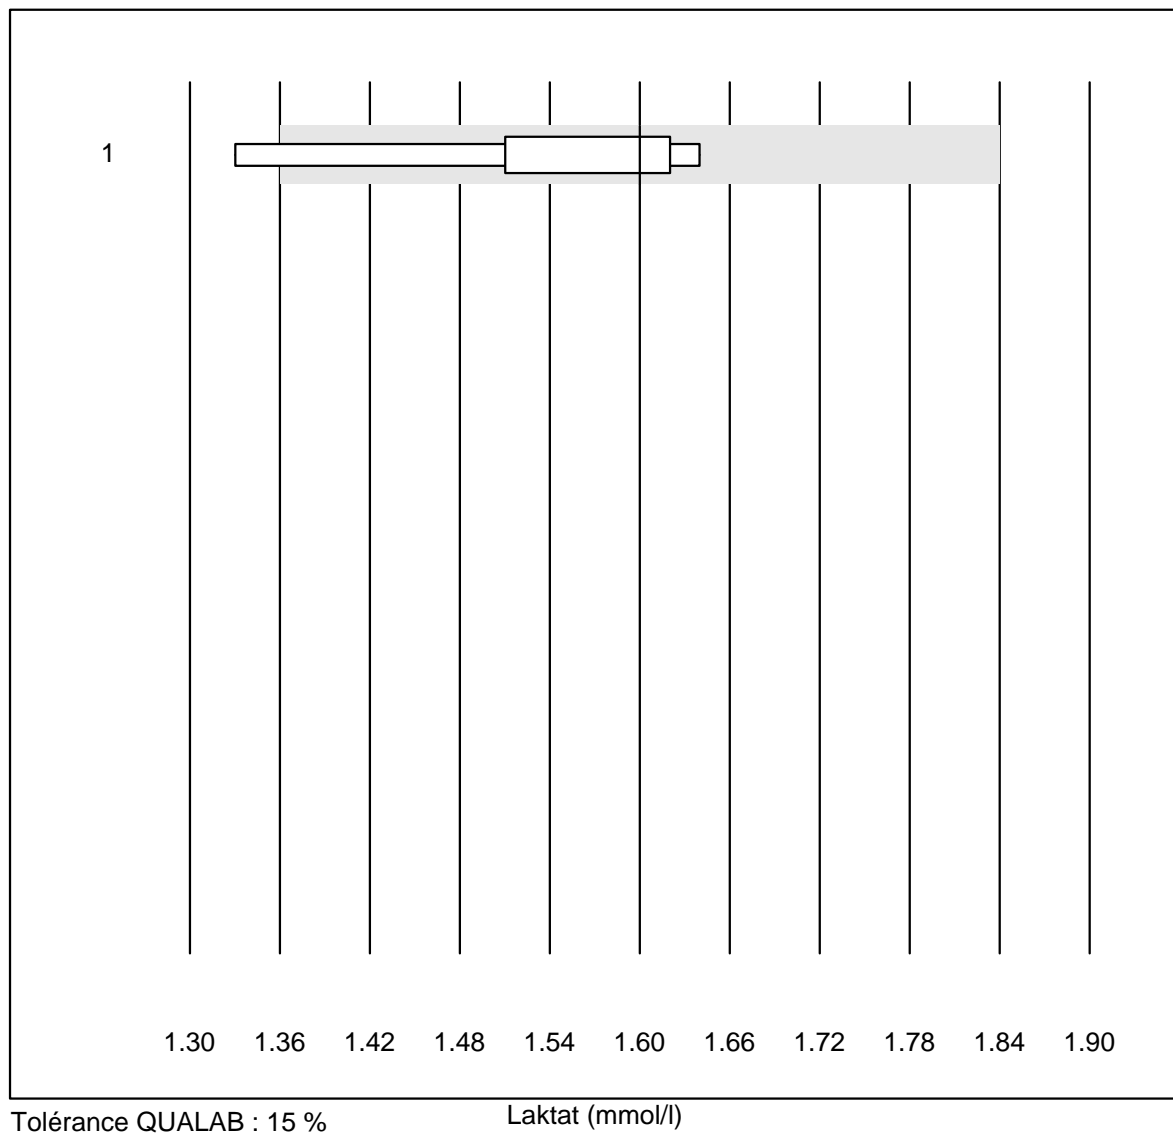

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	8	87.5	12.5	0.0	1.60	6.7	e*

HbA1c échantillon A

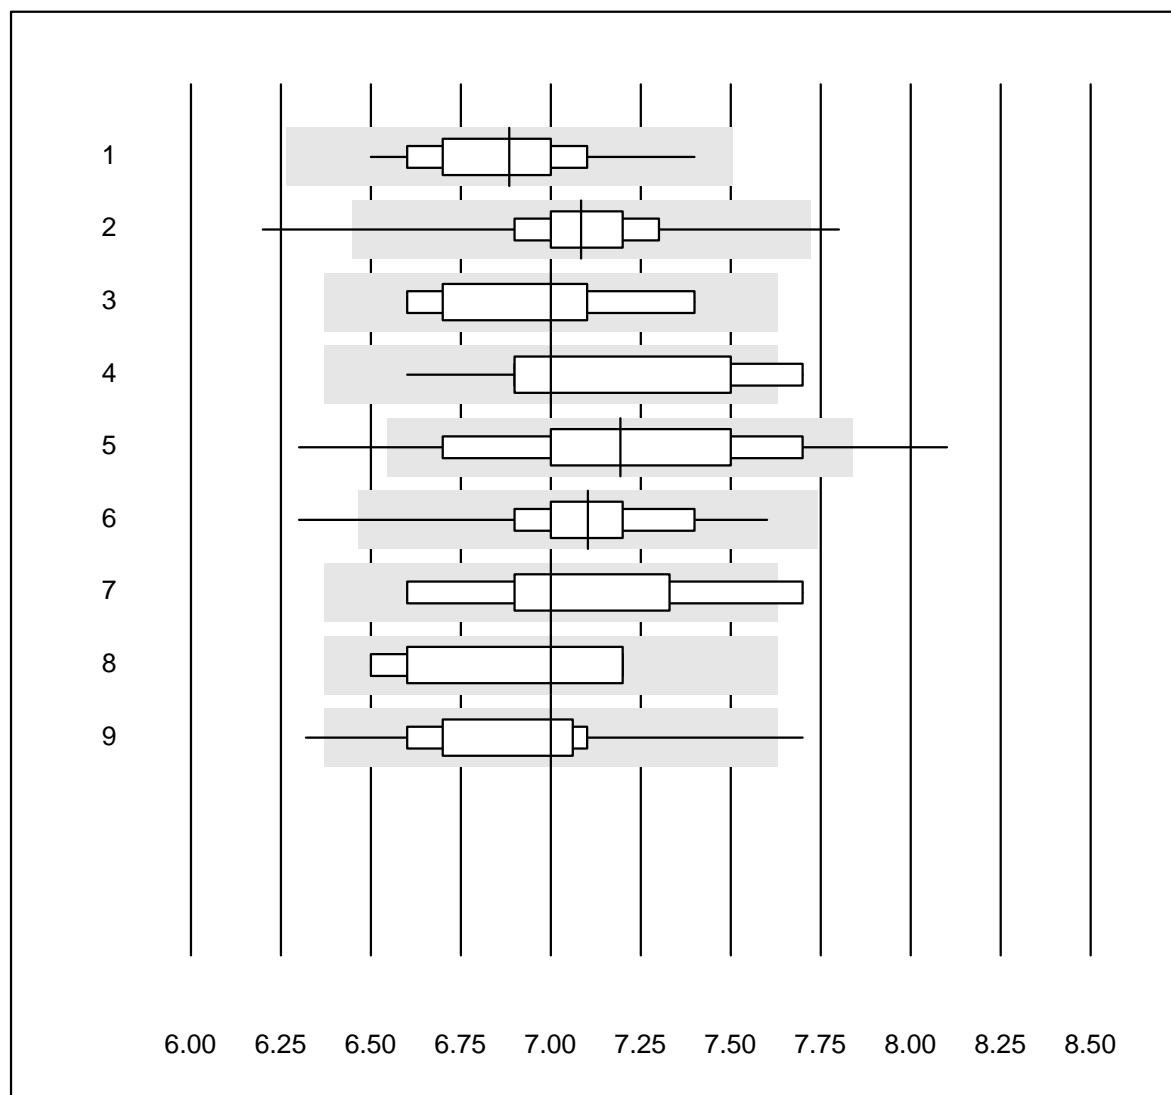


Tolérance QUALAB : 9 %

HbA1c échantillon A (%)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas b101	45	97.8	0.0	2.2	6.9	3.0	e
2	Afinion	676	99.0	0.6	0.4	7.1	2.3	e
3	Eurolyser	17	100.0	0.0	0.0	7.0	3.9	a
4	Hemocue HbA1c 501	12	83.3	16.7	0.0	7.0	5.1	a
5	NycoCard	62	85.5	9.7	4.8	7.2	5.6	e
6	DCA2000/Vantage	214	99.0	0.5	0.5	7.1	2.9	e
7	Andere	10	60.0	20.0	20.0	7.0	5.3	a
8	HPLC	5	100.0	0.0	0.0	7.0	4.8	a
9	Roche, Cobas	18	88.9	11.1	0.0	7.0	4.1	a


HbA1c échantillon B

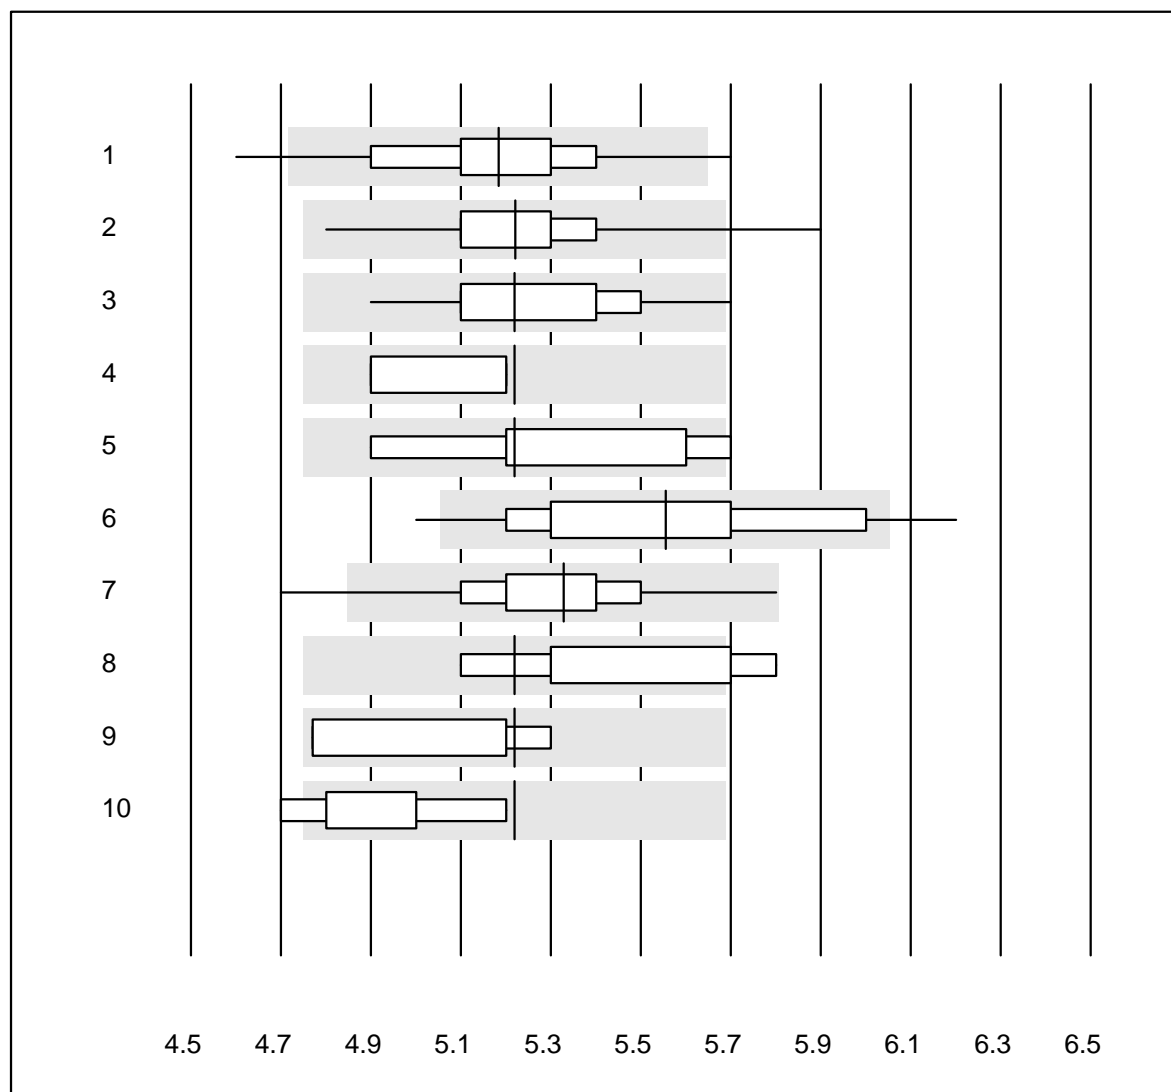


Tolérance QUALAB : 9 %

HbA1c échantillon B (%)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas b101	30	93.3	6.7	0.0	5.2	3.8	e
2	Afinion	610	98.2	1.5	0.3	5.2	2.6	e
3	Eurolyser	19	94.7	5.3	0.0	5.2	3.5	a
4	A1c Now	4	75.0	0.0	25.0	5.2	3.0	a
5	Hemocue HbA1c 501	6	66.6	16.7	16.7	5.2	6.0	a
6	NycoCard	70	85.7	5.7	8.6	5.6	4.9	e
7	DCA2000/Vantage	215	98.1	0.5	1.4	5.3	3.2	e
8	Andere	6	50.0	33.3	16.7	5.2	5.3	a
9	HPLC	4	100.0	0.0	0.0	5.2	4.5	a
10	Roche, Cobas	13	76.9	15.4	7.7	5.2	3.3	a

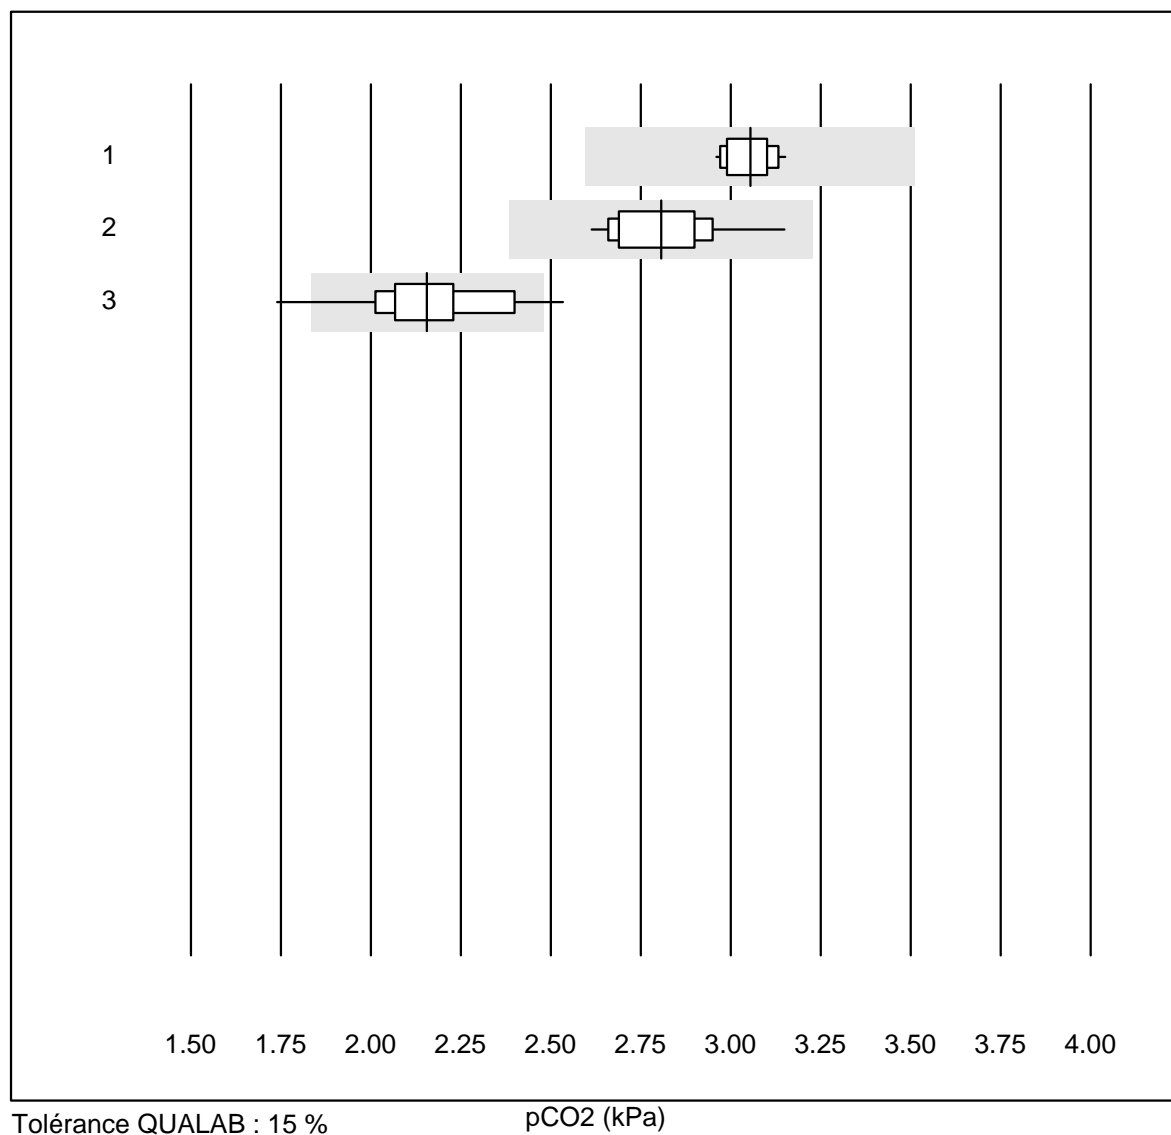pCO₂

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas b121/123/221	16	100.0	0.0	0.0	3.05	2.1	e
2	iStat	38	100.0	0.0	0.0	2.81	4.2	e
3	EPOC	25	84.0	12.0	4.0	2.16	7.9	e

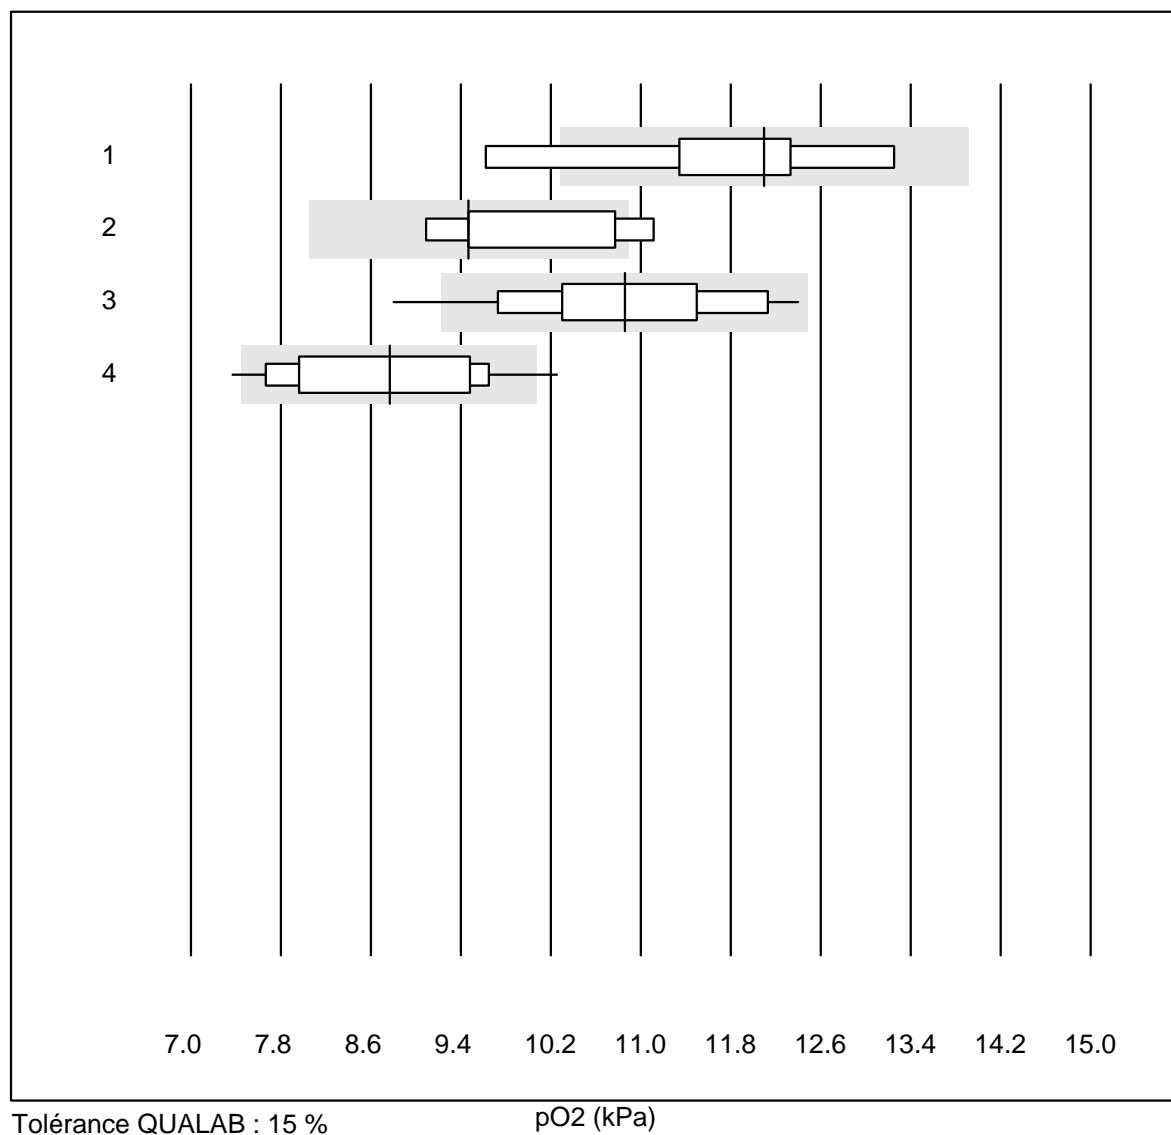
pO₂

Tolérance QUALAB : 15 %

pO₂ (kPa)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas b221	6	83.3	16.7	0.0	12.10	10.4	e*
2	Cobas b121/123	7	57.1	14.3	28.6	9.47	8.4	e*
3	iStat	38	89.4	5.3	5.3	10.86	8.4	e
4	EPOC	25	76.0	12.0	12.0	8.77	9.9	e*

pH

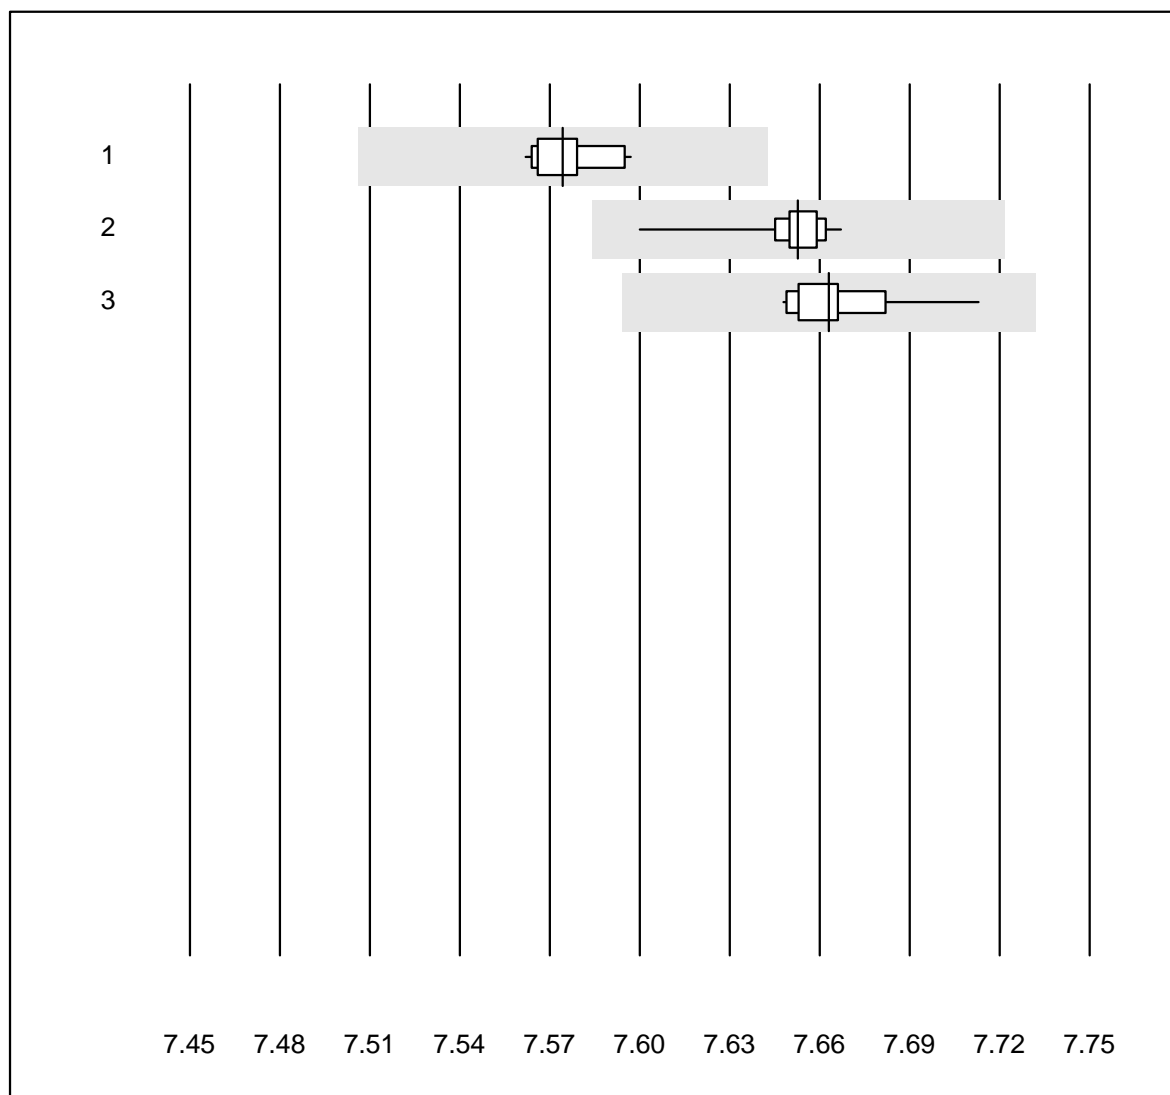


Tolérance QUALAB : 1 %

pH ()

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas b121/123/221	15	100.0	0.0	0.0	7.57	0.1	e
2	iStat	39	97.4	0.0	2.6	7.65	0.1	e
3	EPOC	25	100.0	0.0	0.0	7.66	0.2	e

Glucose GS

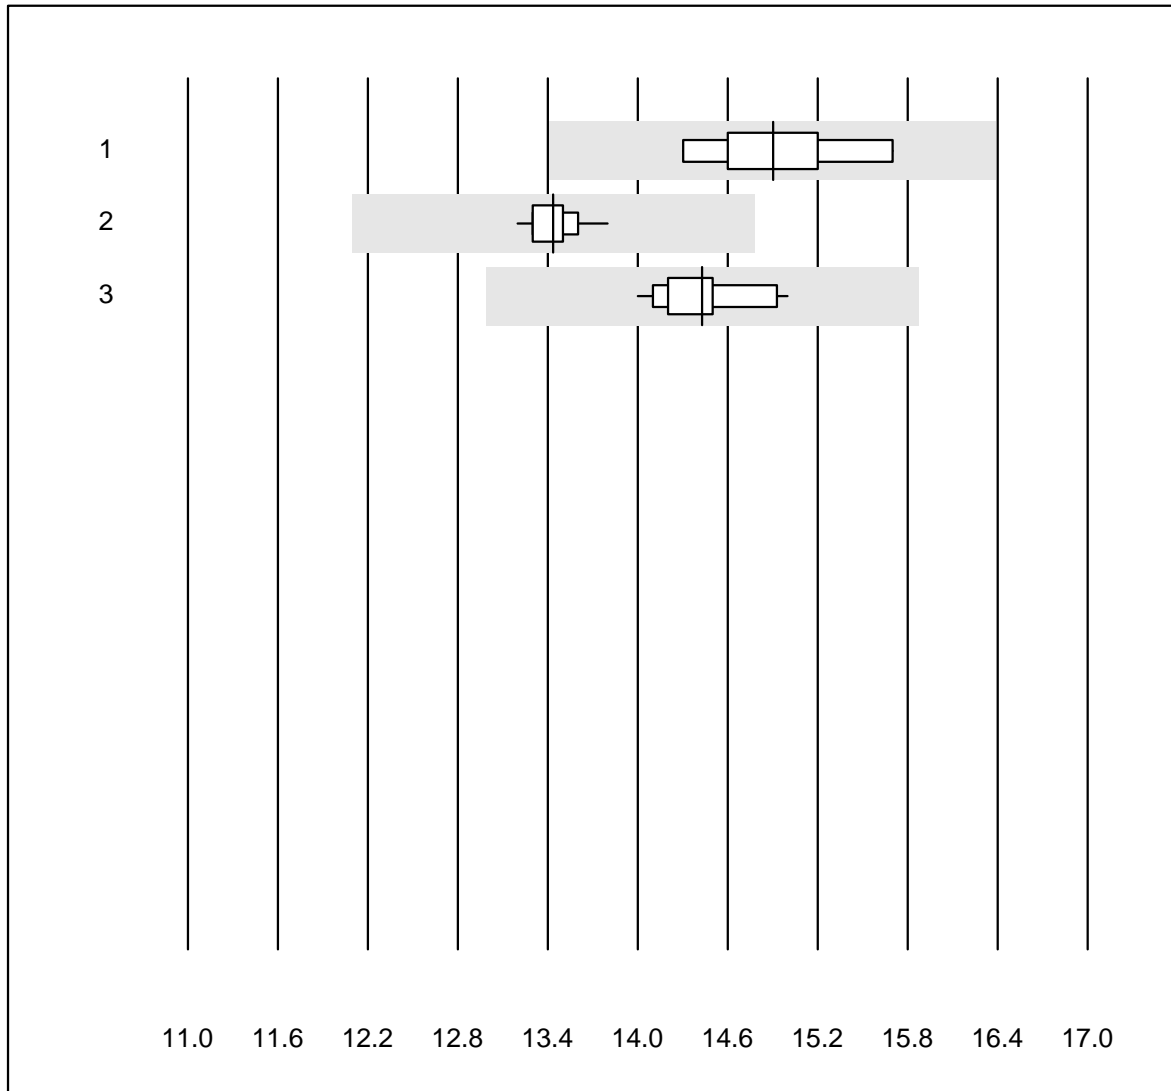


Tolérance QUALAB : 10 %

Glucose GS (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas b121/123/221	8	100.0	0.0	0.0	14.9	2.9	e
2	iStat	11	100.0	0.0	0.0	13.4	1.2	e
3	EPOC	16	100.0	0.0	0.0	14.4	2.1	e

Potassium BG

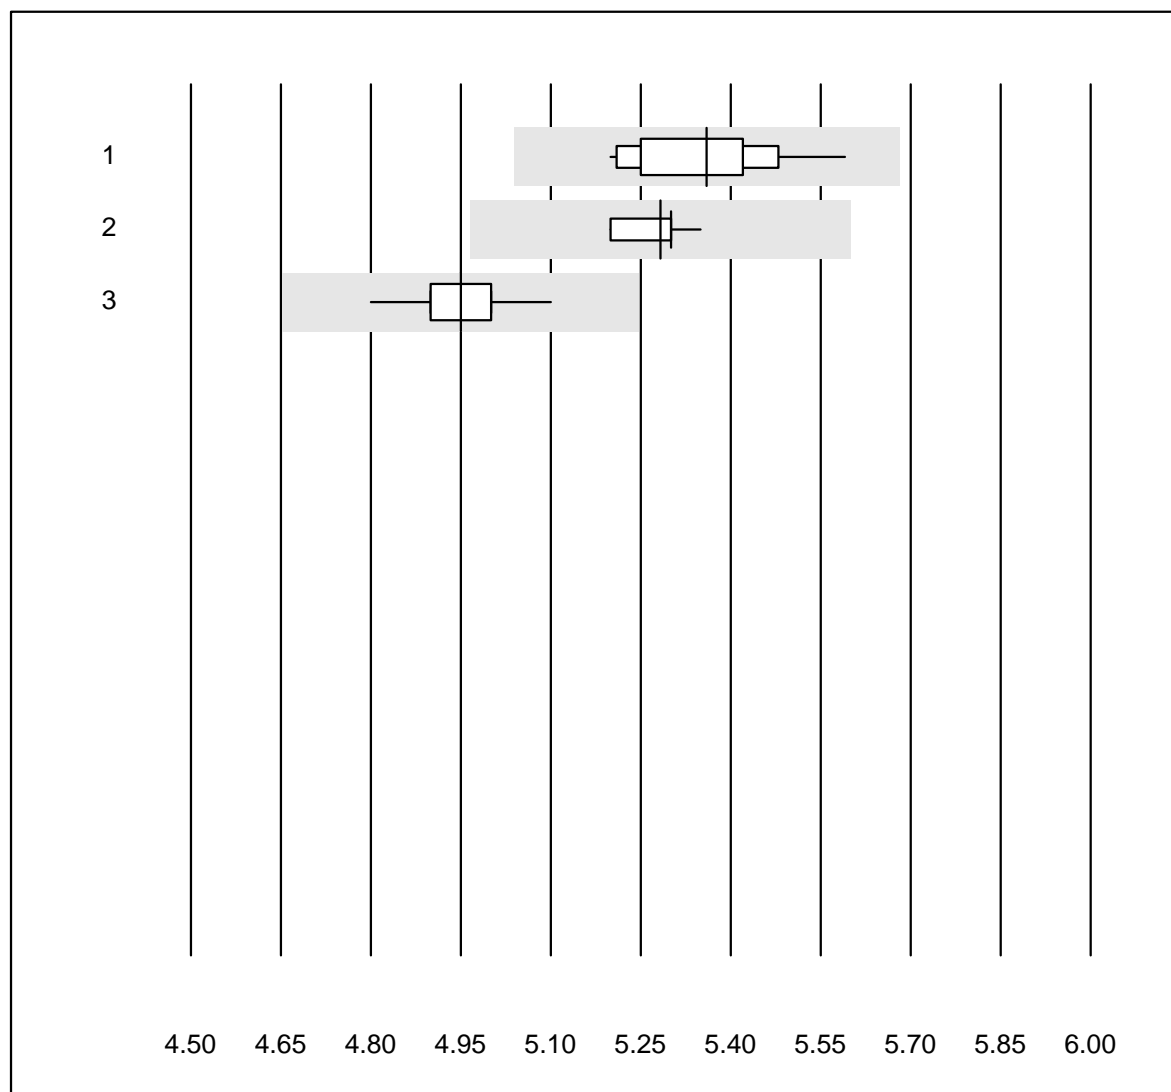


Tolérance QUALAB : 6 %

Potassium BG (mmol/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas b121/123/221	15	93.3	0.0	6.7	5.4	2.1	e
2	iStat	21	100.0	0.0	0.0	5.3	0.8	e
3	EPOC	20	100.0	0.0	0.0	5.0	1.5	e

Sodium BG

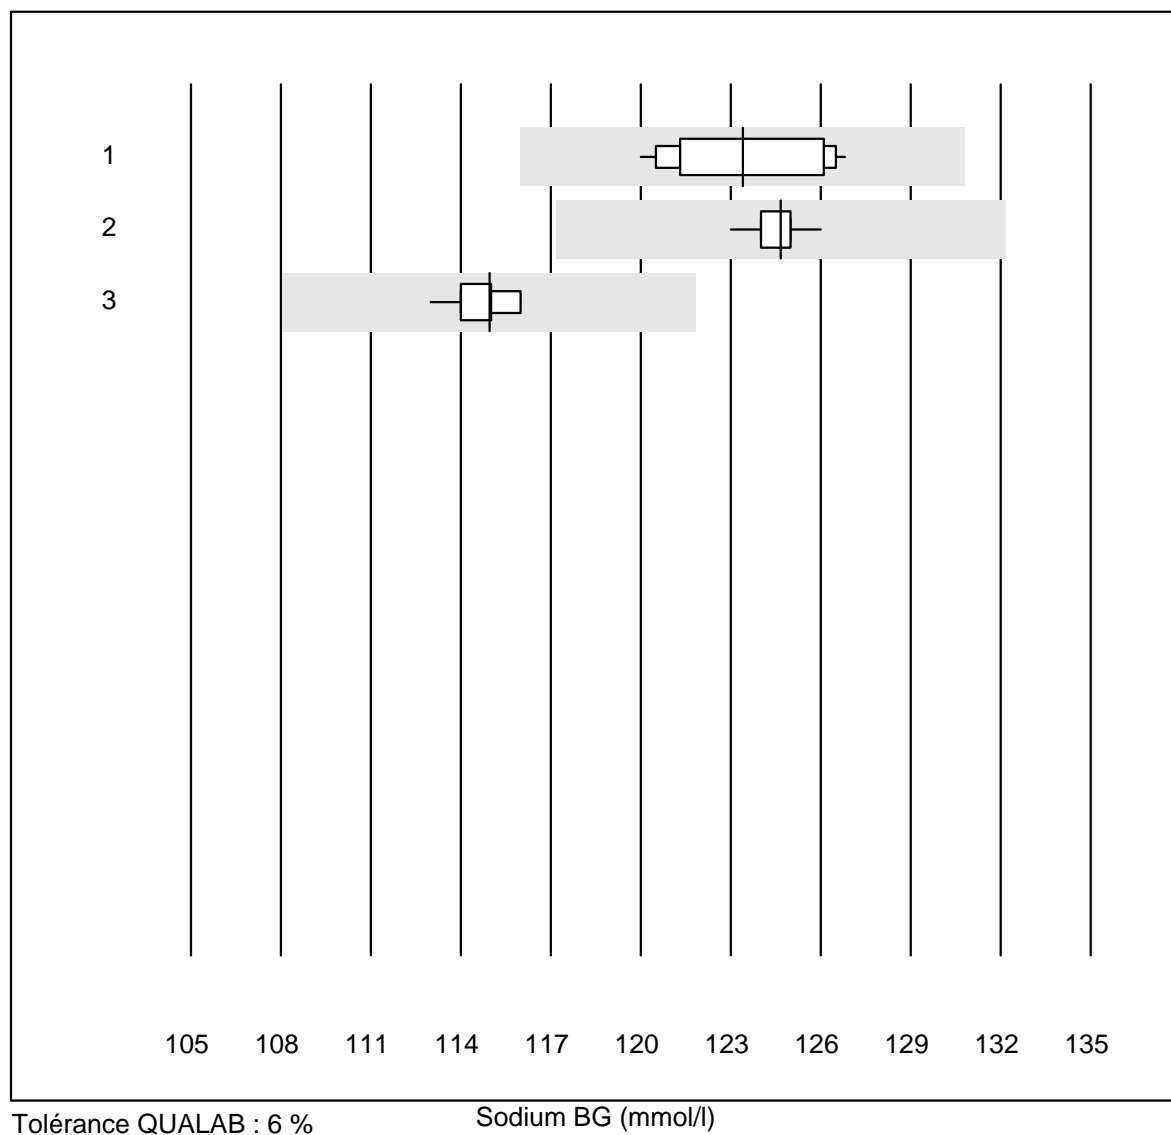

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas b121/123/221	16	93.7	0.0	6.3	123.4	2.0	e
2	iStat	21	100.0	0.0	0.0	124.7	0.6	e
3	EPOC	20	100.0	0.0	0.0	115.0	0.7	e

Chlorure-BG

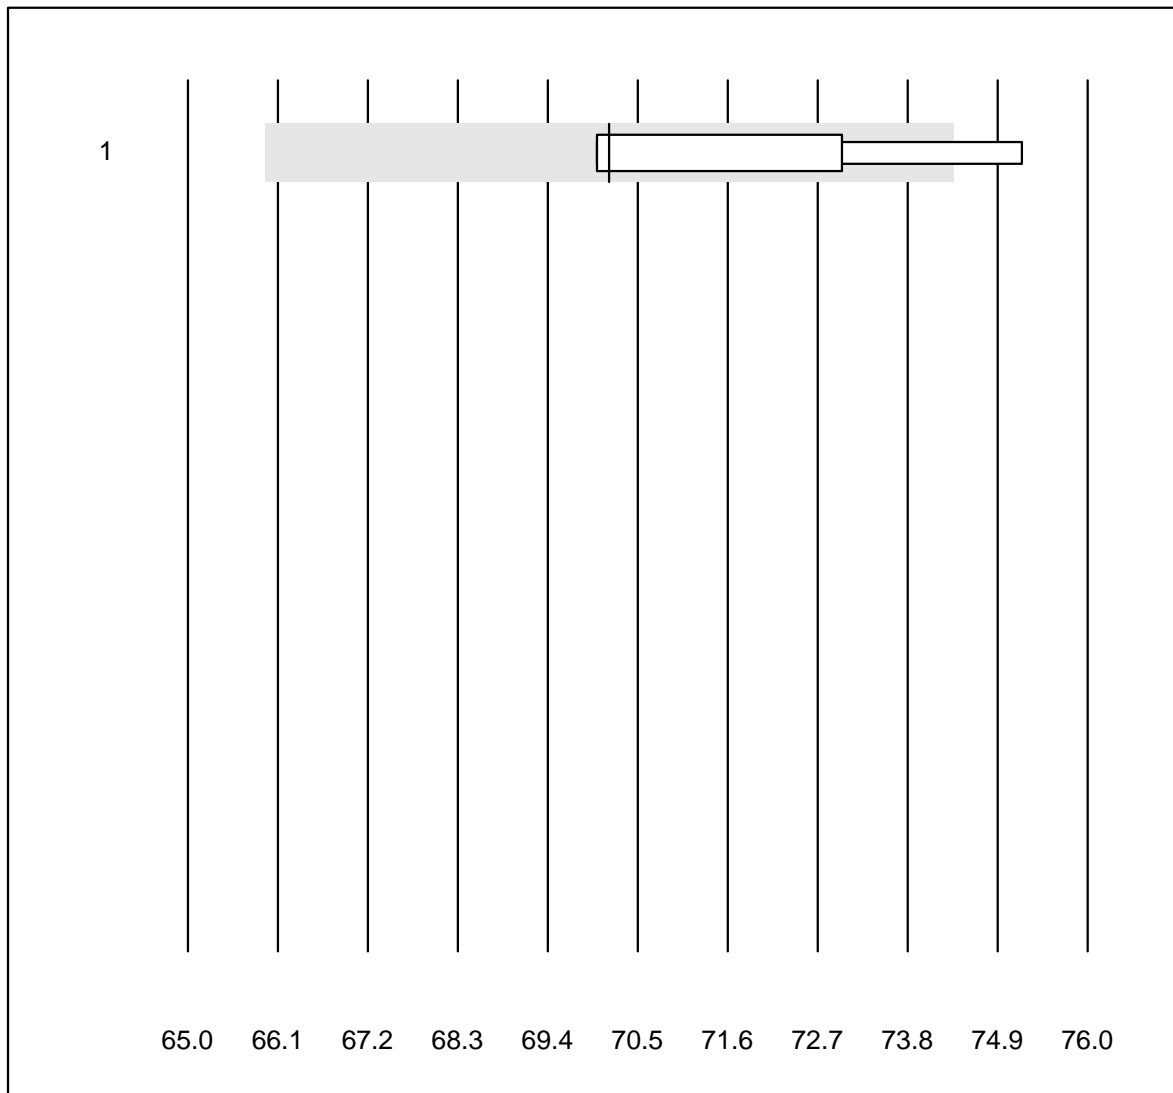


Tolérance QUALAB : 6 %

Chlorure-BG (mmol/l)

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas b121/123/221	6	83.3	16.7	0.0	70.2	3.1	e*

Calcium-BG

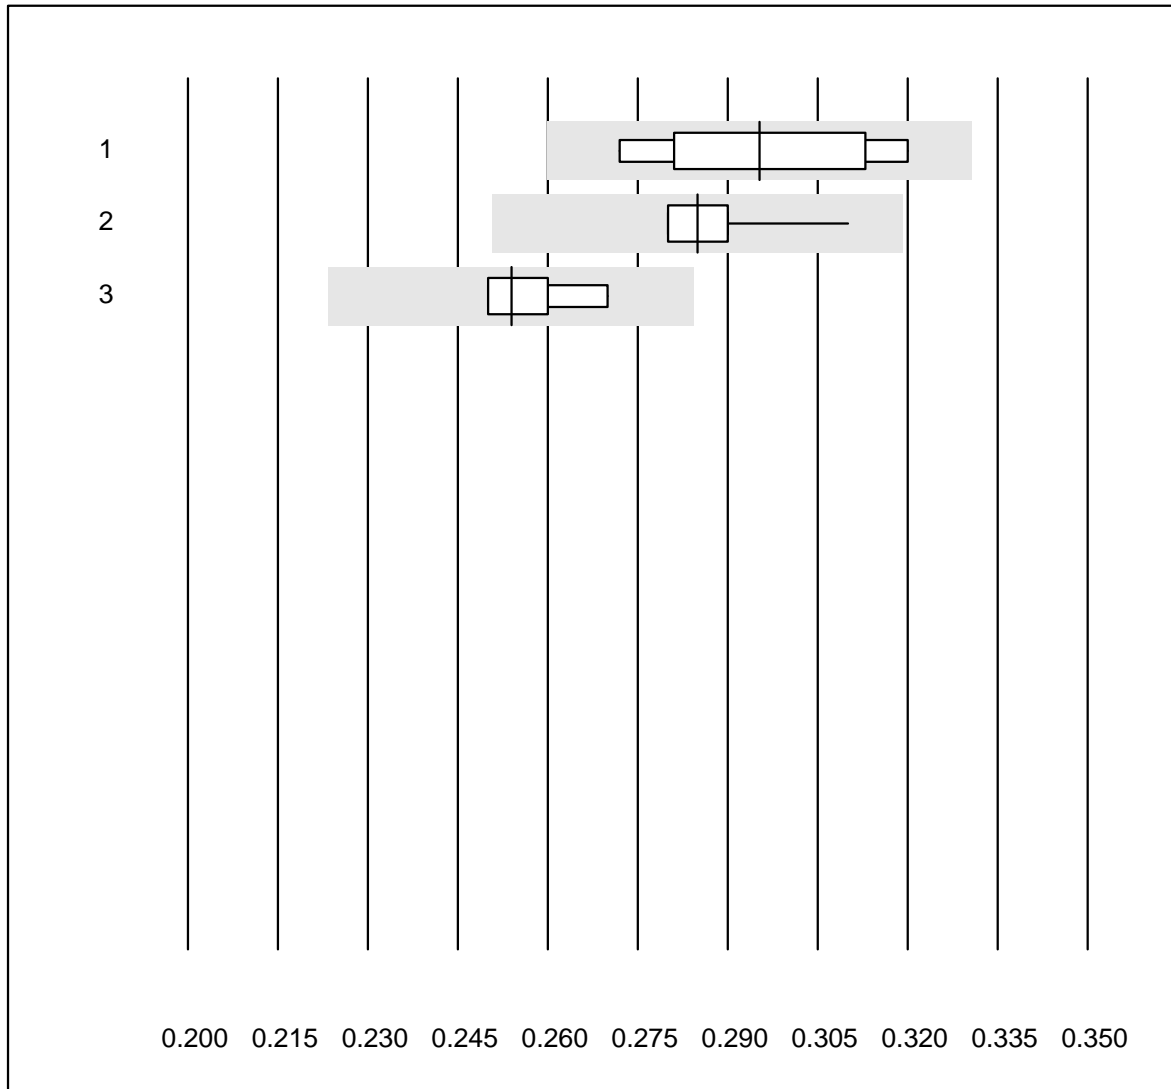


Tolérance QUALAB : 12 %

Calcium-BG (mmol/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas b121/123/221	11	81.8	0.0	18.2	0.30	6.4	e*
2	iStat	11	90.9	0.0	9.1	0.29	3.4	e
3	EPOC	18	100.0	0.0	0.0	0.25	2.7	e

Lactate-BG

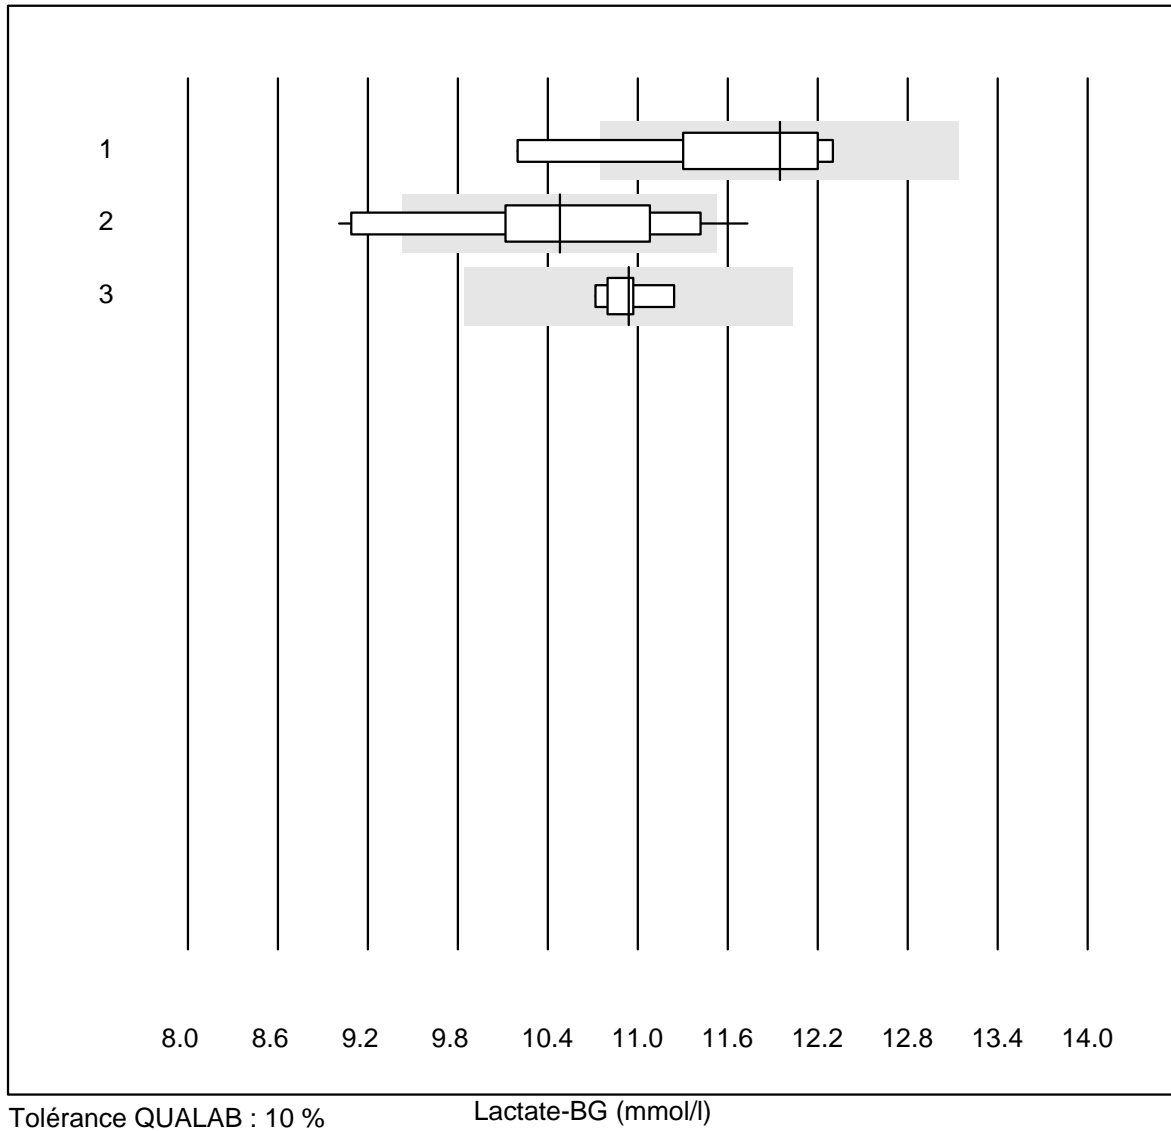

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas b121/123/221	6	83.3	16.7	0.0	11.95	6.8	e*
2	EPOC	21	62.0	19.0	19.0	10.48	8.0	e*
3	iStat	9	100.0	0.0	0.0	10.94	1.6	e

sO2

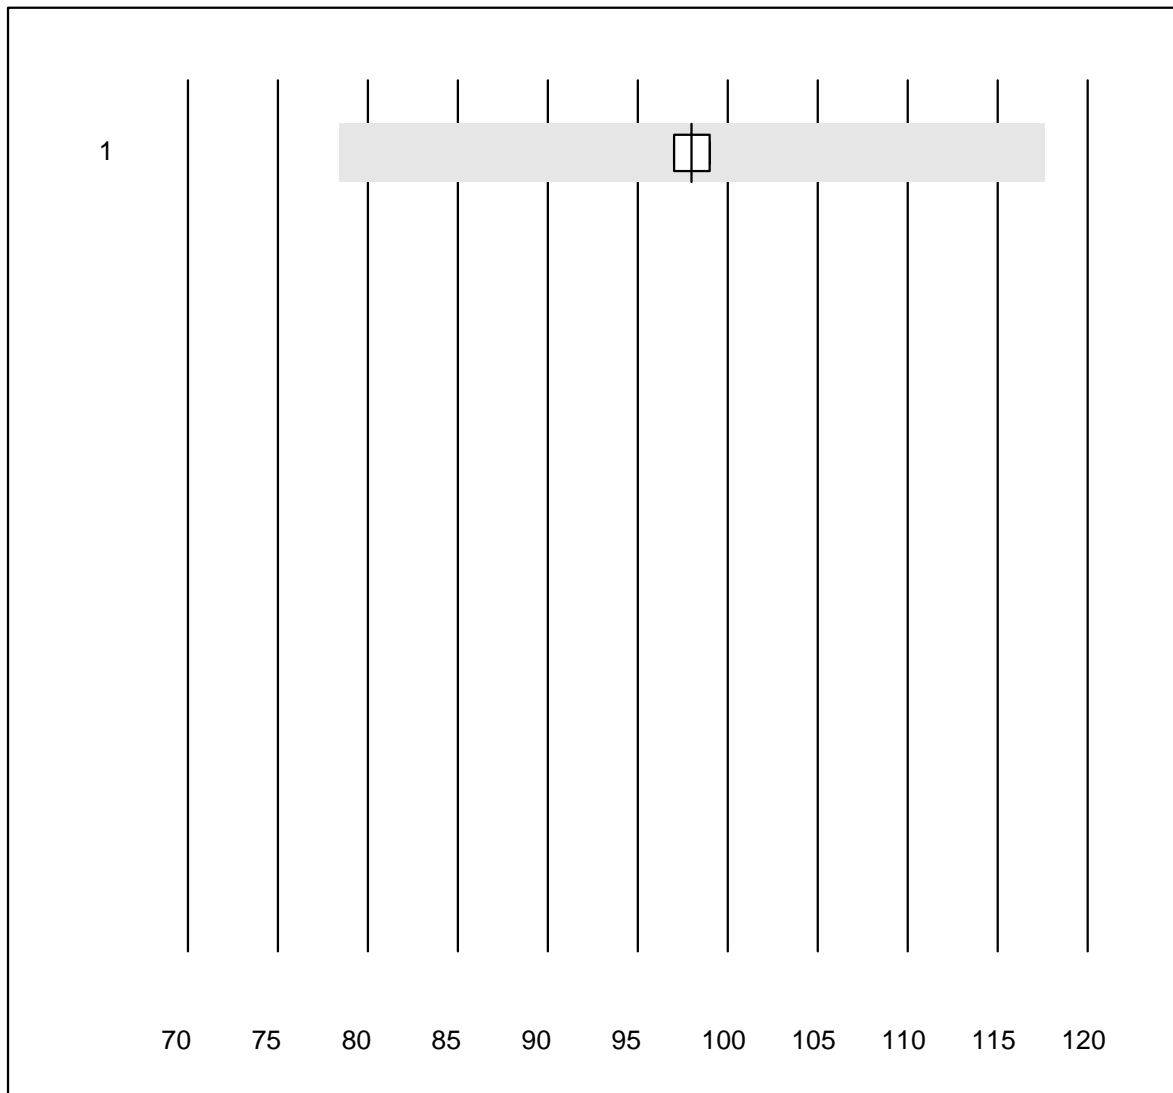


Tolérance QUALAB : 20 %

sO2 (%)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 iStat	7	100.0	0.0	0.0	98.000	0.8	e

Calcium - urine

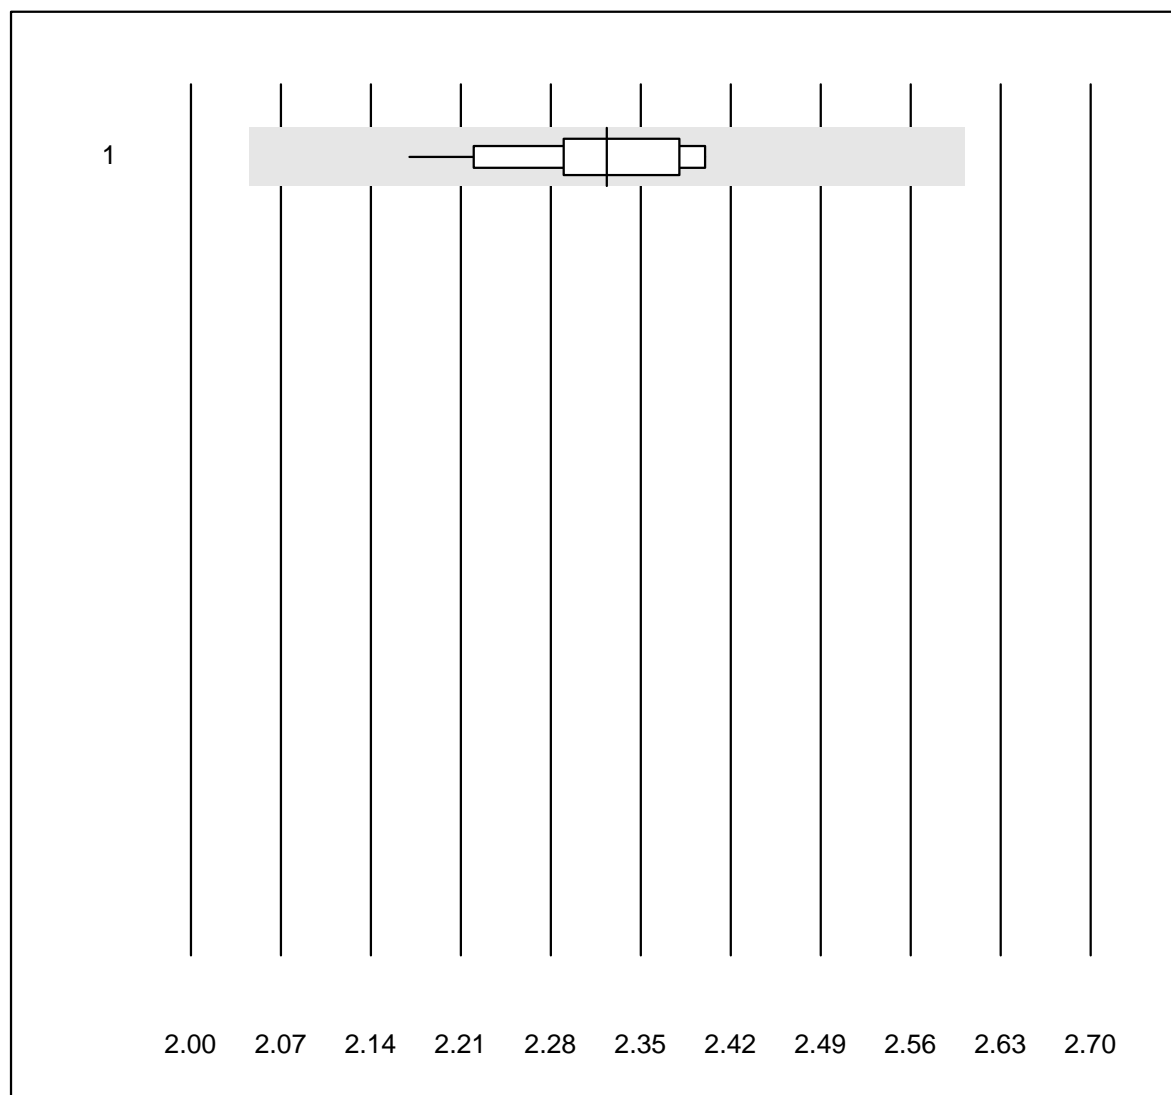


Tolérance QUALAB : 12 %

Calcium - urine (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	13	100.0	0.0	0.0	2.32	3.2	e

Chlorures - urine

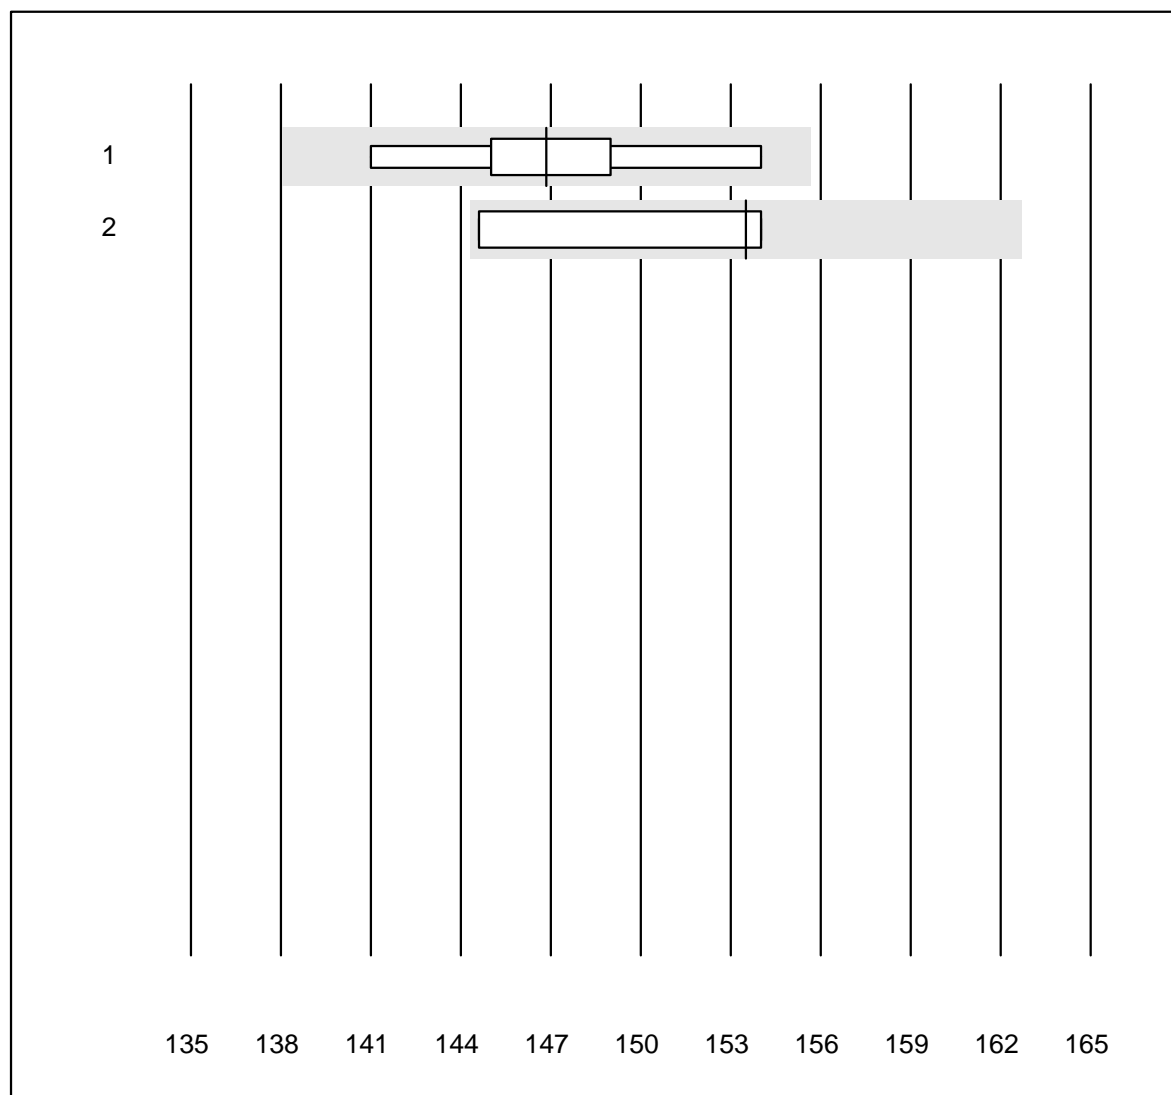


Tolérance QUALAB : 6 %

Chlorures - urine (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	6	100.0	0.0	0.0	147	2.9	e*
2	ISE direct	4	100.0	0.0	0.0	154	3.0	e*

Glucose - urine

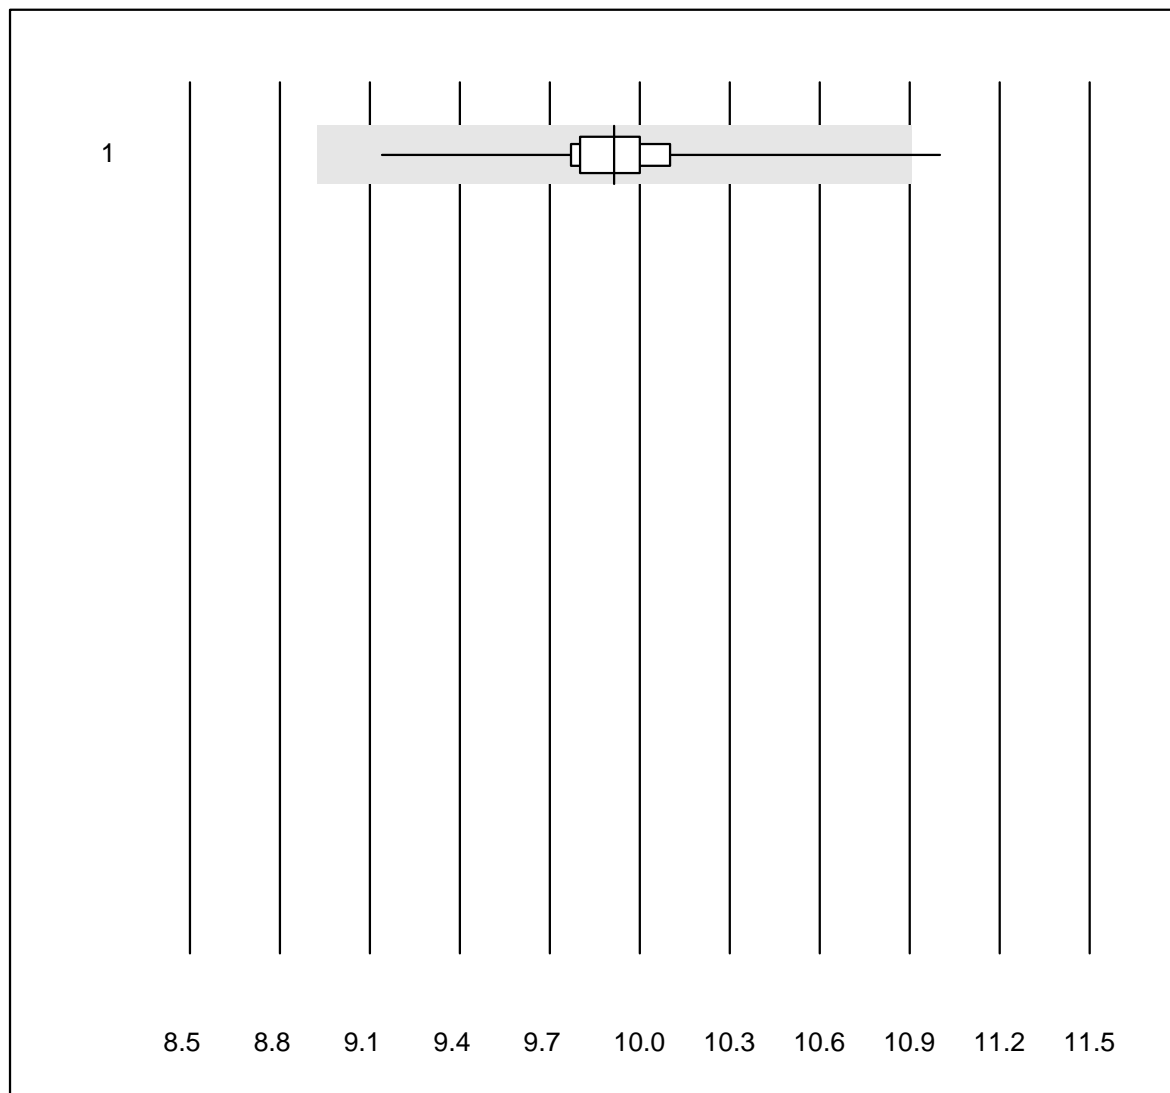


Tolérance QUALAB : 10 %

Glucose - urine (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	13	92.3	7.7	0.0	9.9	4.1	e

Magnésium - urine

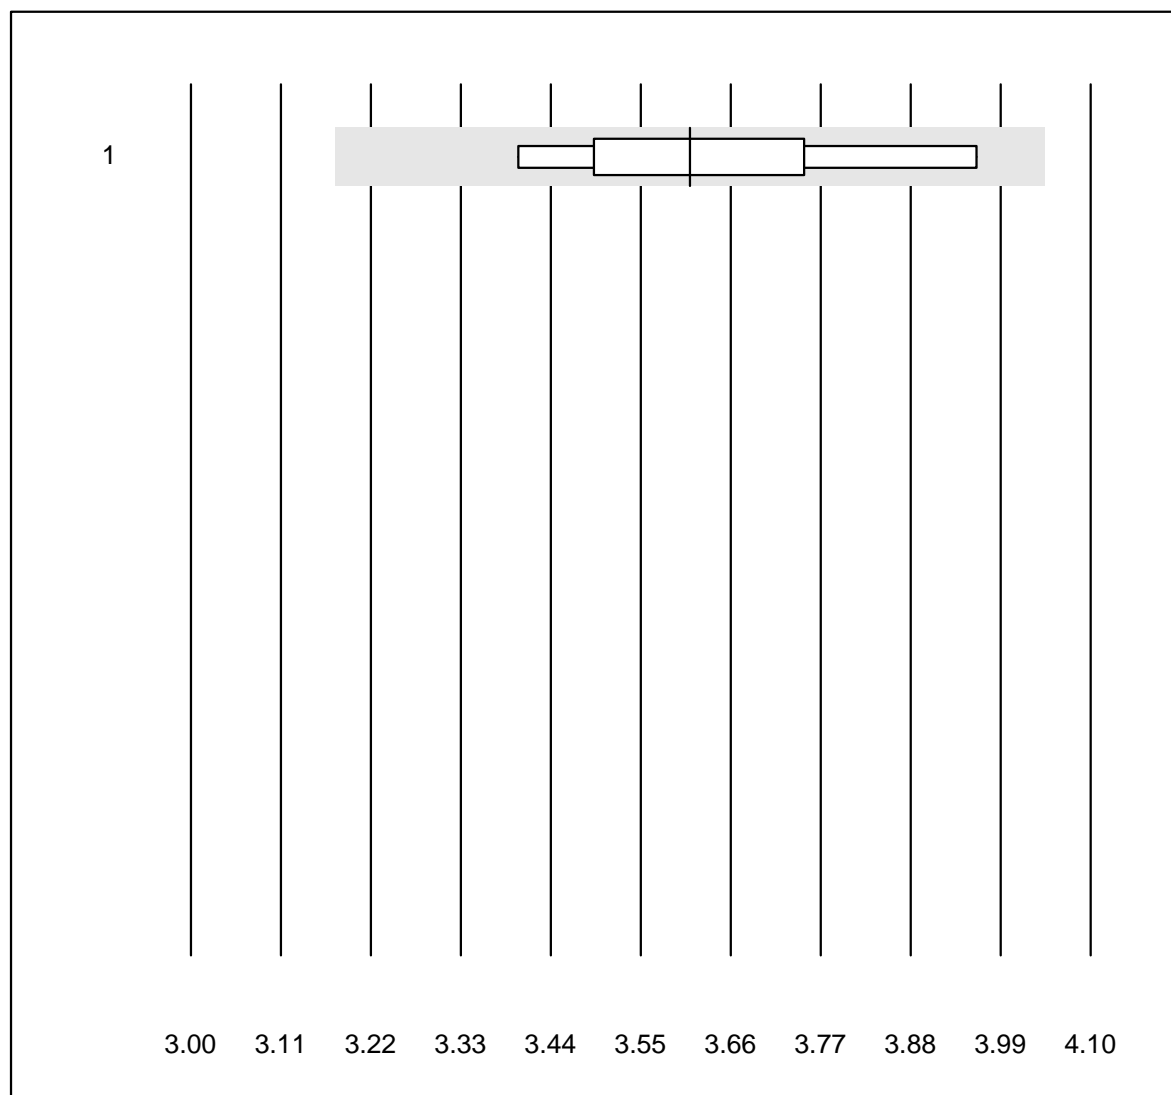


Tolérance QUALAB : 12 %

Magnésium - urine (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	8	100.0	0.0	0.0	3.61	5.5	e*

Osmolalité -urine

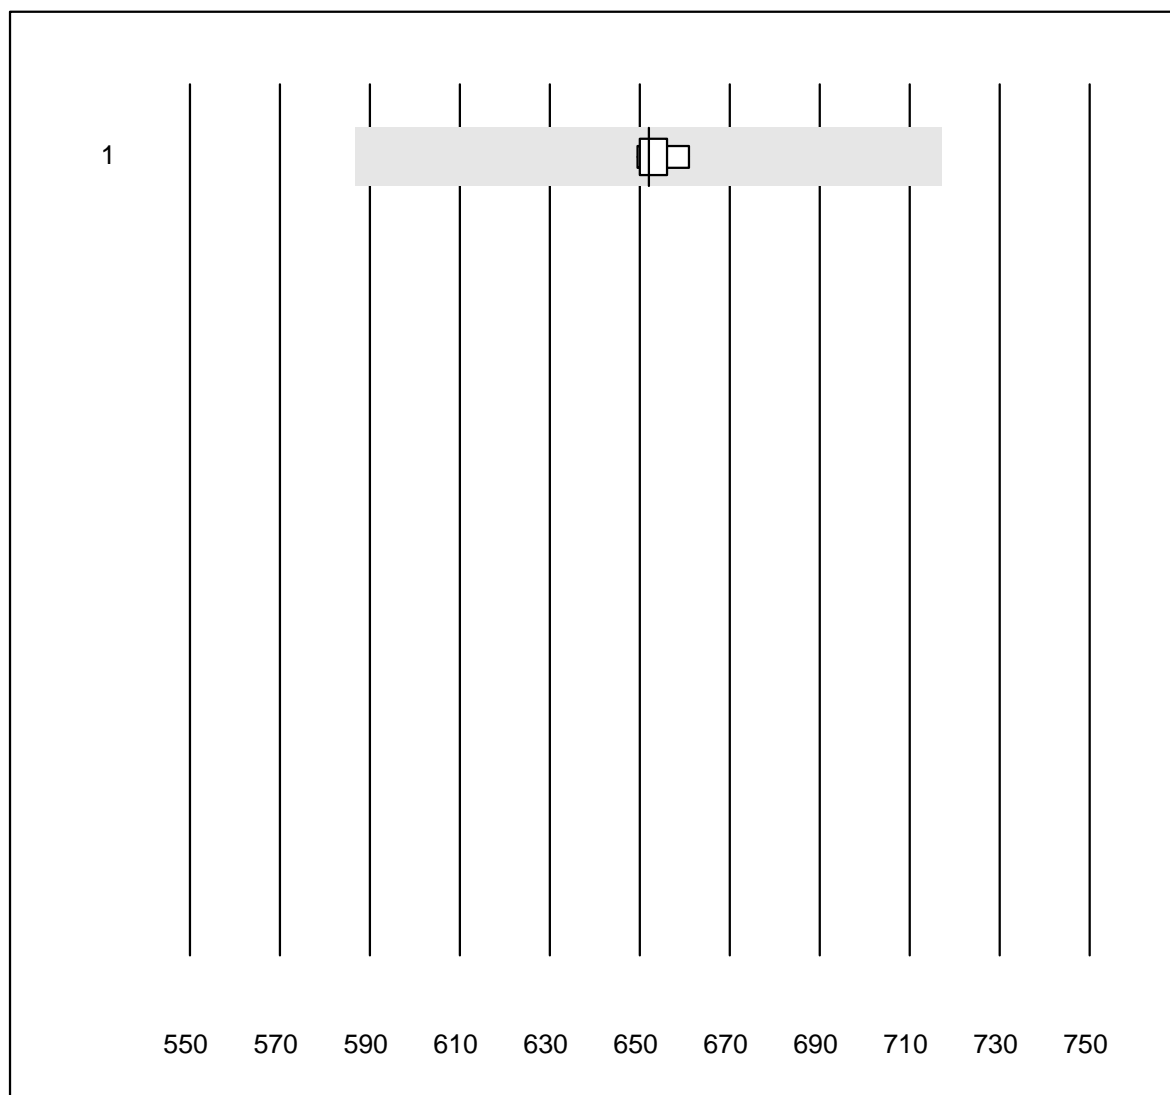


Tolérance QUALAB : 10 %

Osmolalité -urine (mosm/kg)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cryoscopie	7	100.0	0.0	0.0	652	0.6	e

Phosphore - urine

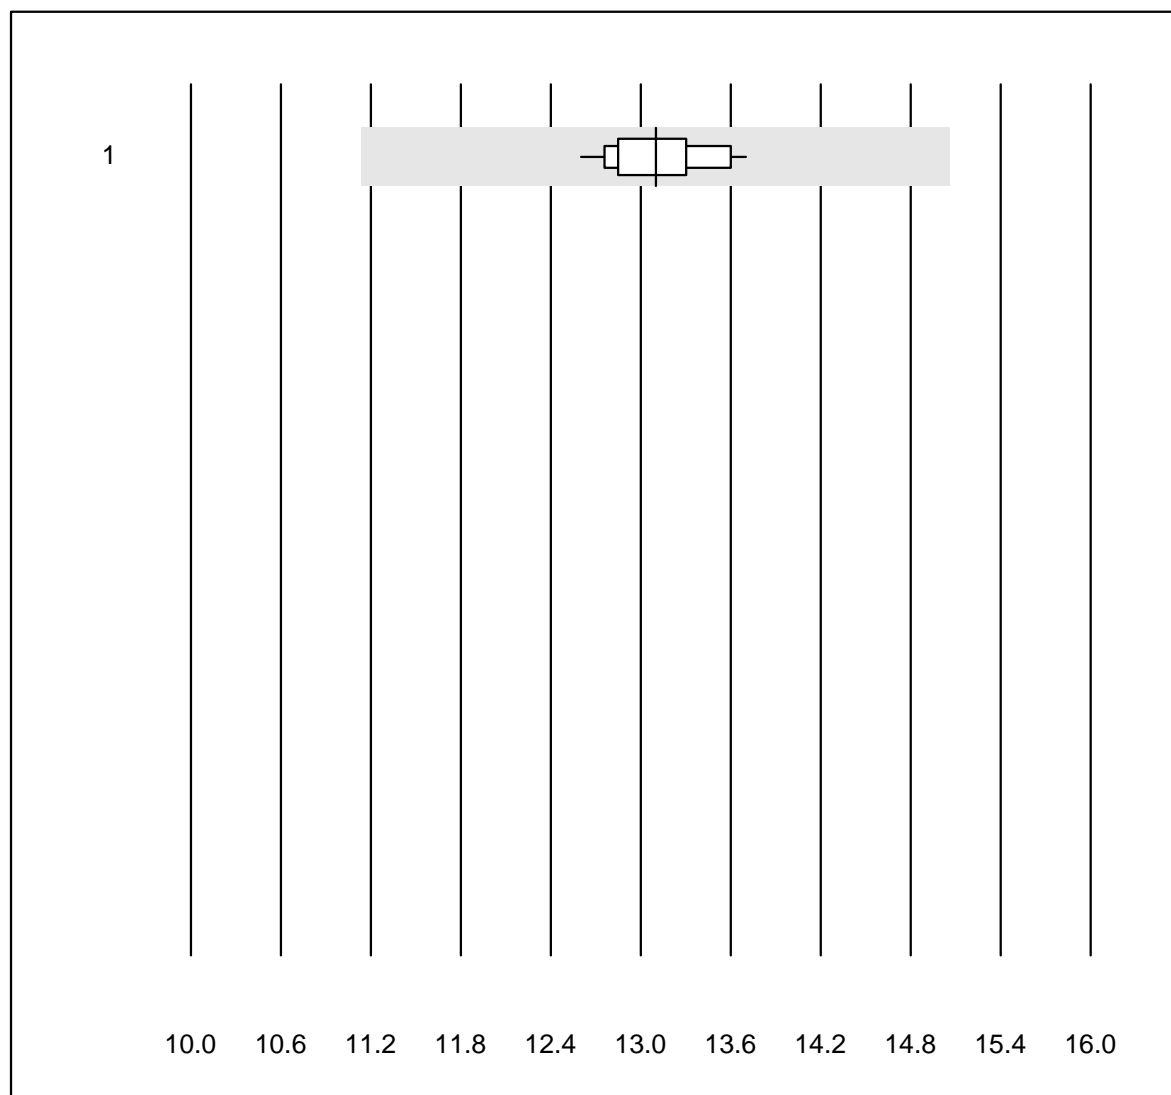


Tolérance QUALAB : 15 %

Phosphore - urine (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	13	100.0	0.0	0.0	13.1	2.5	e

Potassium - urine

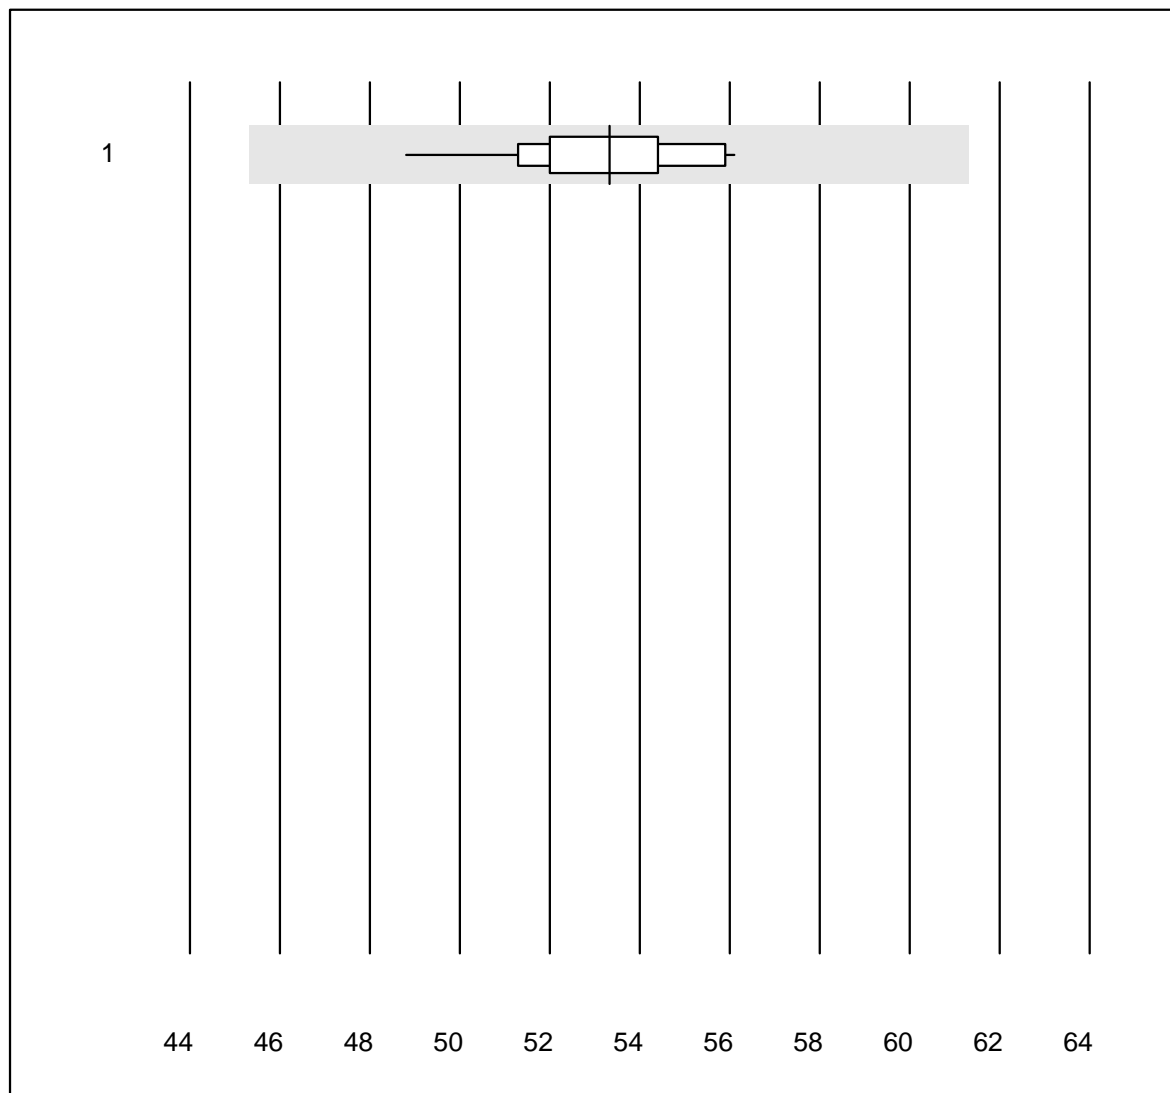


Tolérance QUALAB : 15 %

Potassium - urine (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	19	100.0	0.0	0.0	53	3.5	e

Protéines - urine

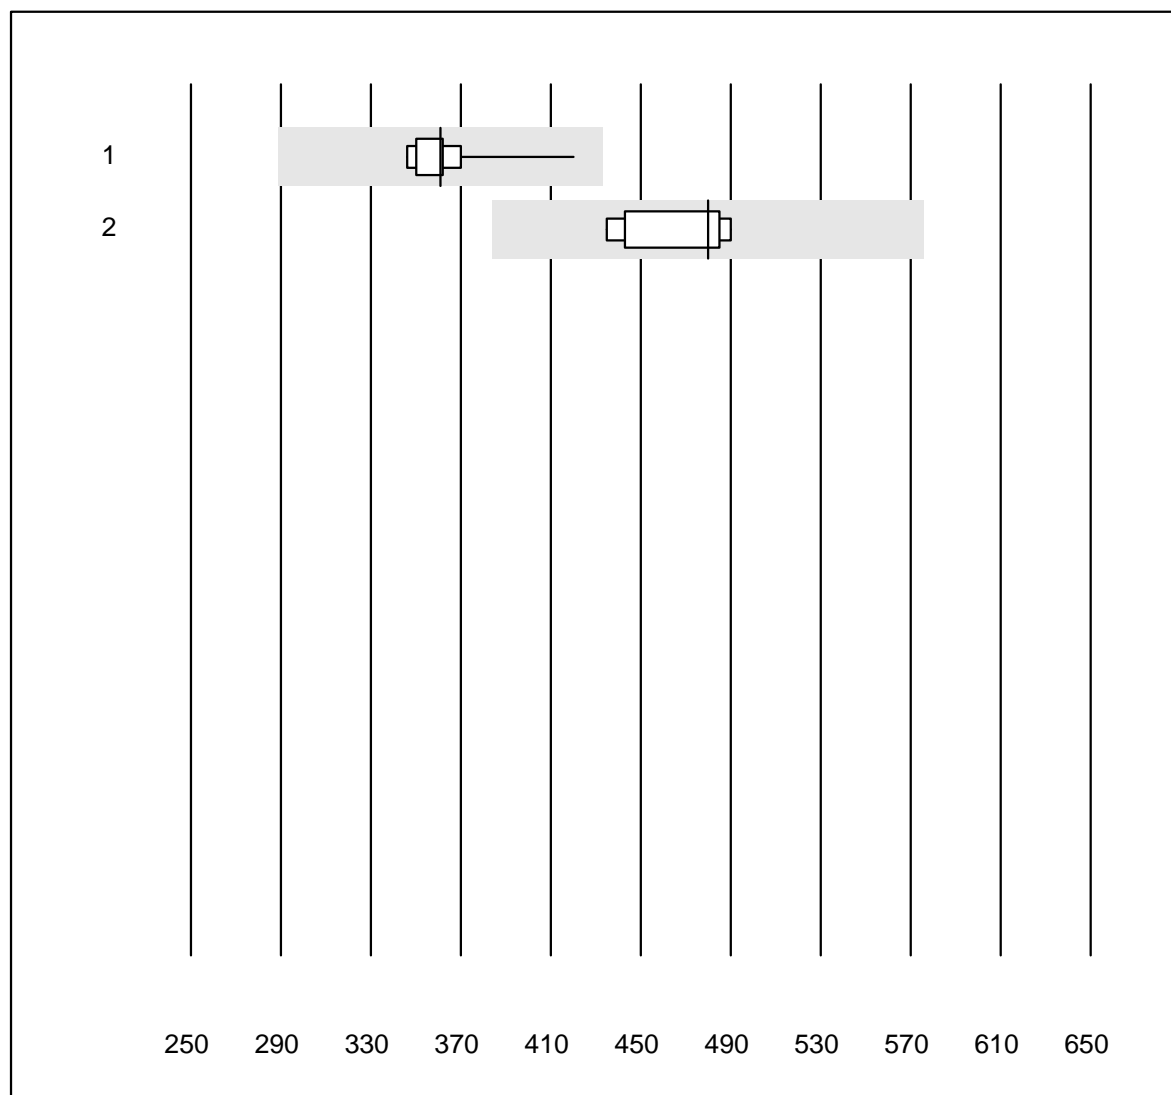


Tolérance QUALAB : 20 %

Protéines - urine (mg/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas/Roche	13	100.0	0.0	0.0	360.8	5.4	e
2	Chimie humide	5	100.0	0.0	0.0	480.0	5.5	e*

Sodium - urine

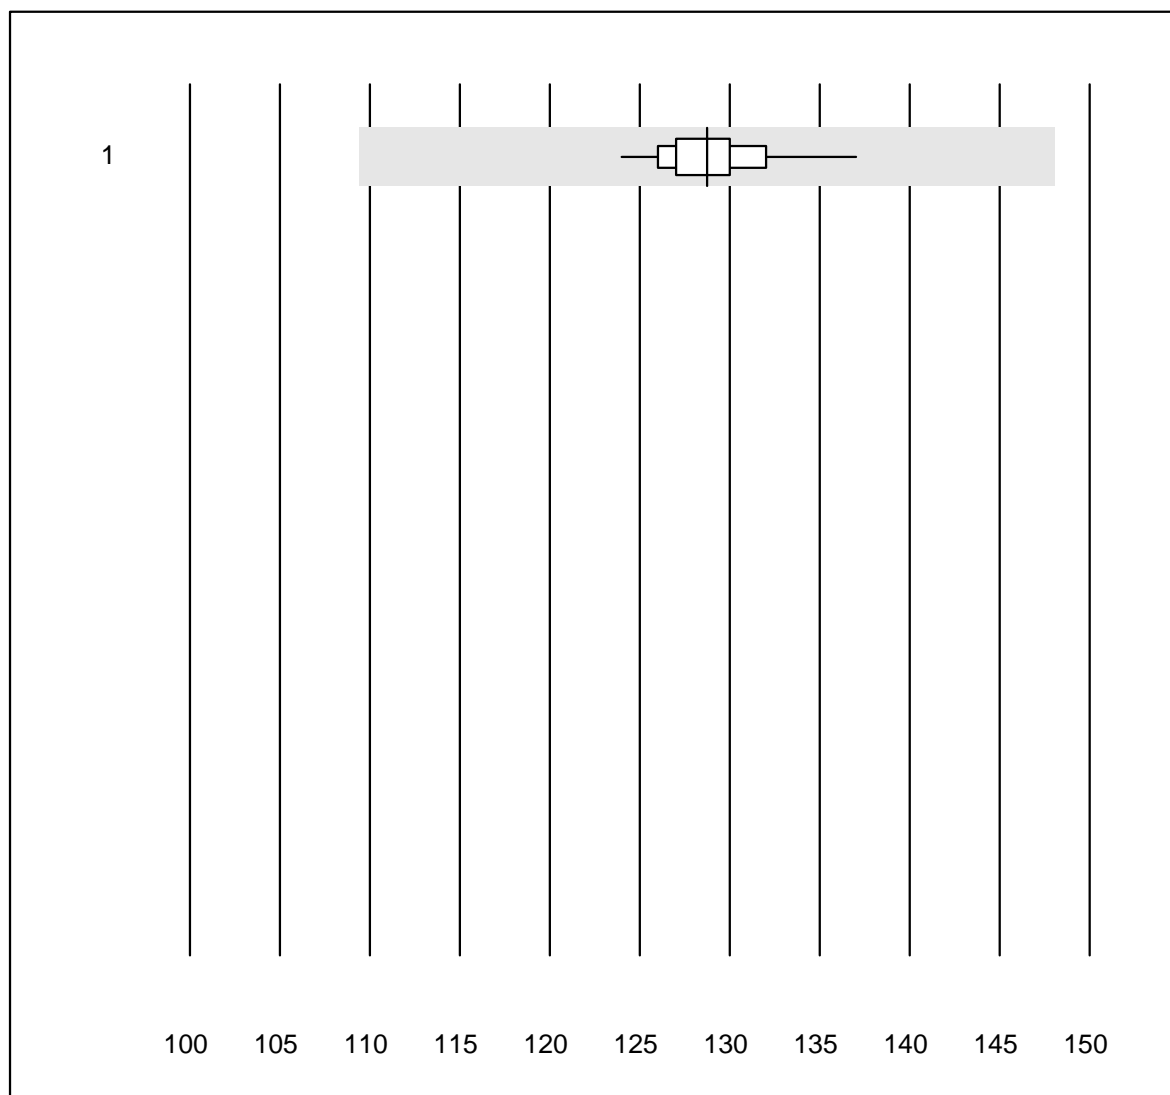


Tolérance QUALAB : 15 %

Sodium - urine (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	19	100.0	0.0	0.0	129	2.2	e

Urée - urine

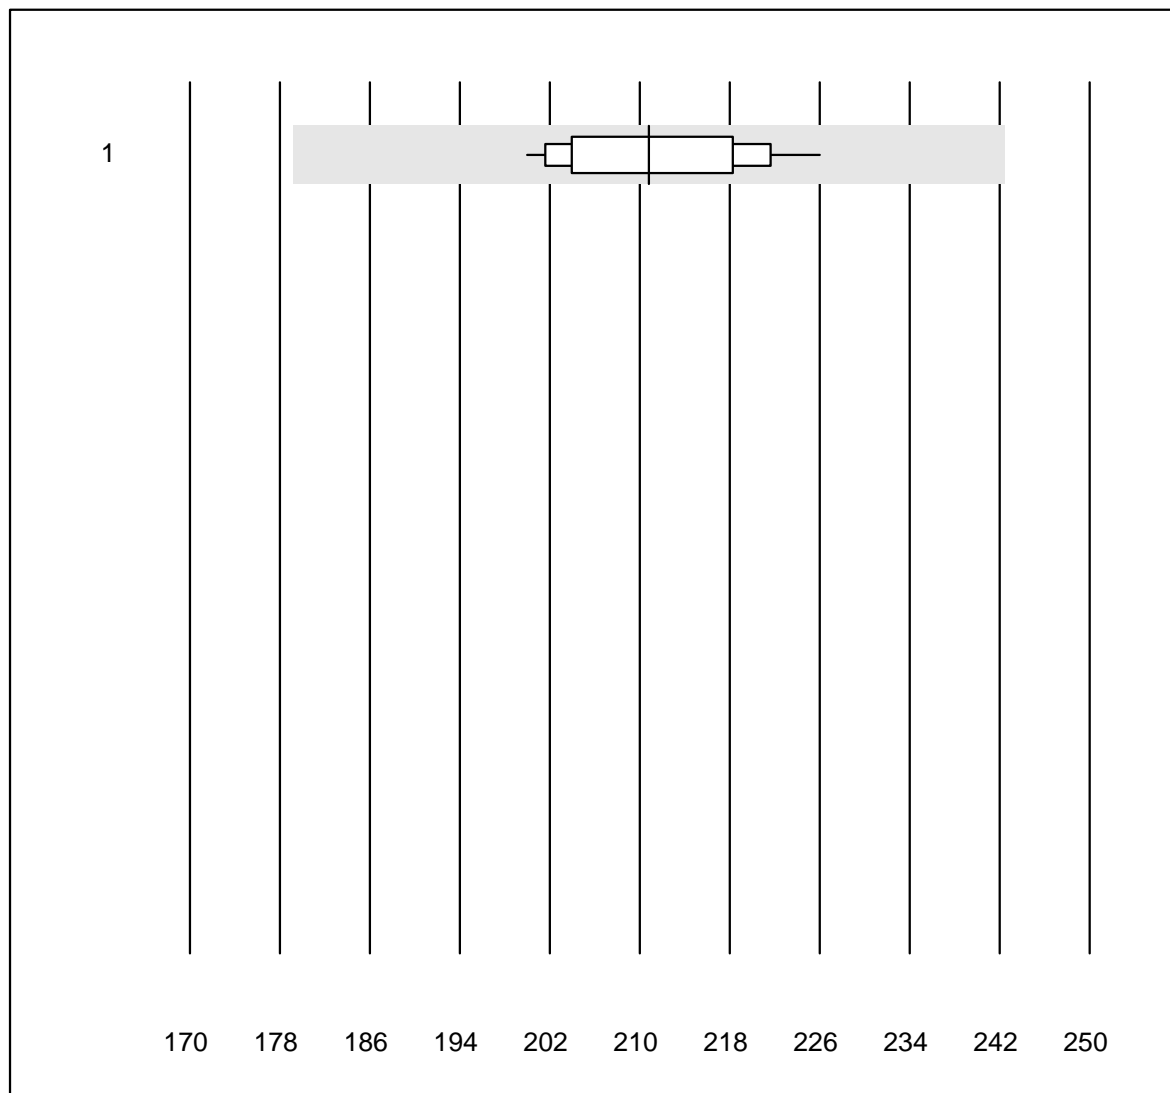


Tolérance QUALAB : 15 %

Urée - urine (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	14	100.0	0.0	0.0	211	4.1	e

Acide urique - urine

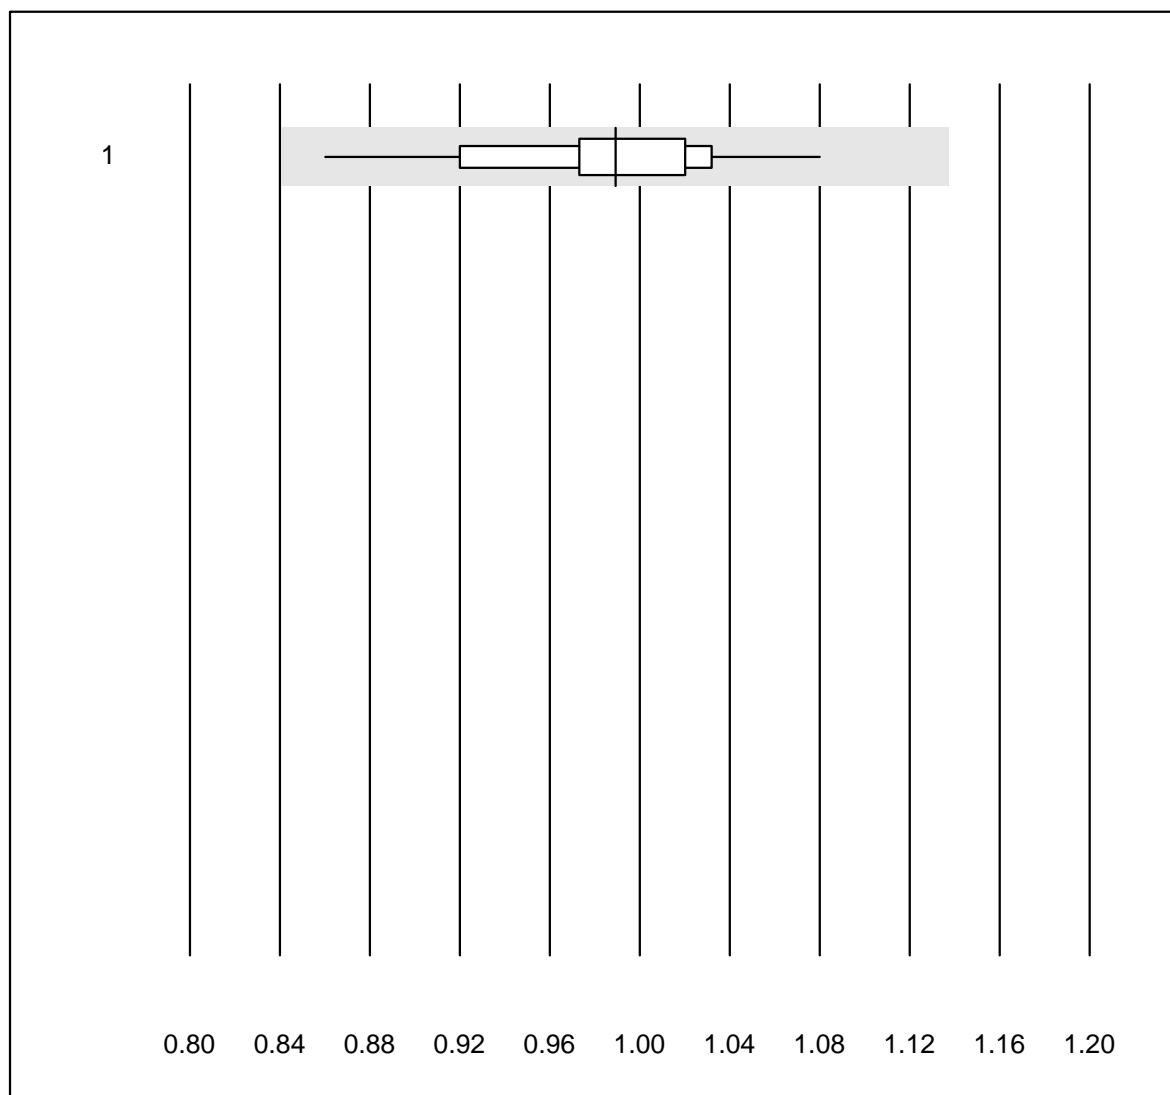


Tolérance QUALAB : 15 %

Acide urique - urine (mmol/l)

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Chimie humide	13	100.0	0.0	0.0	0.99	5.5	e

Gravité spécifique - urine

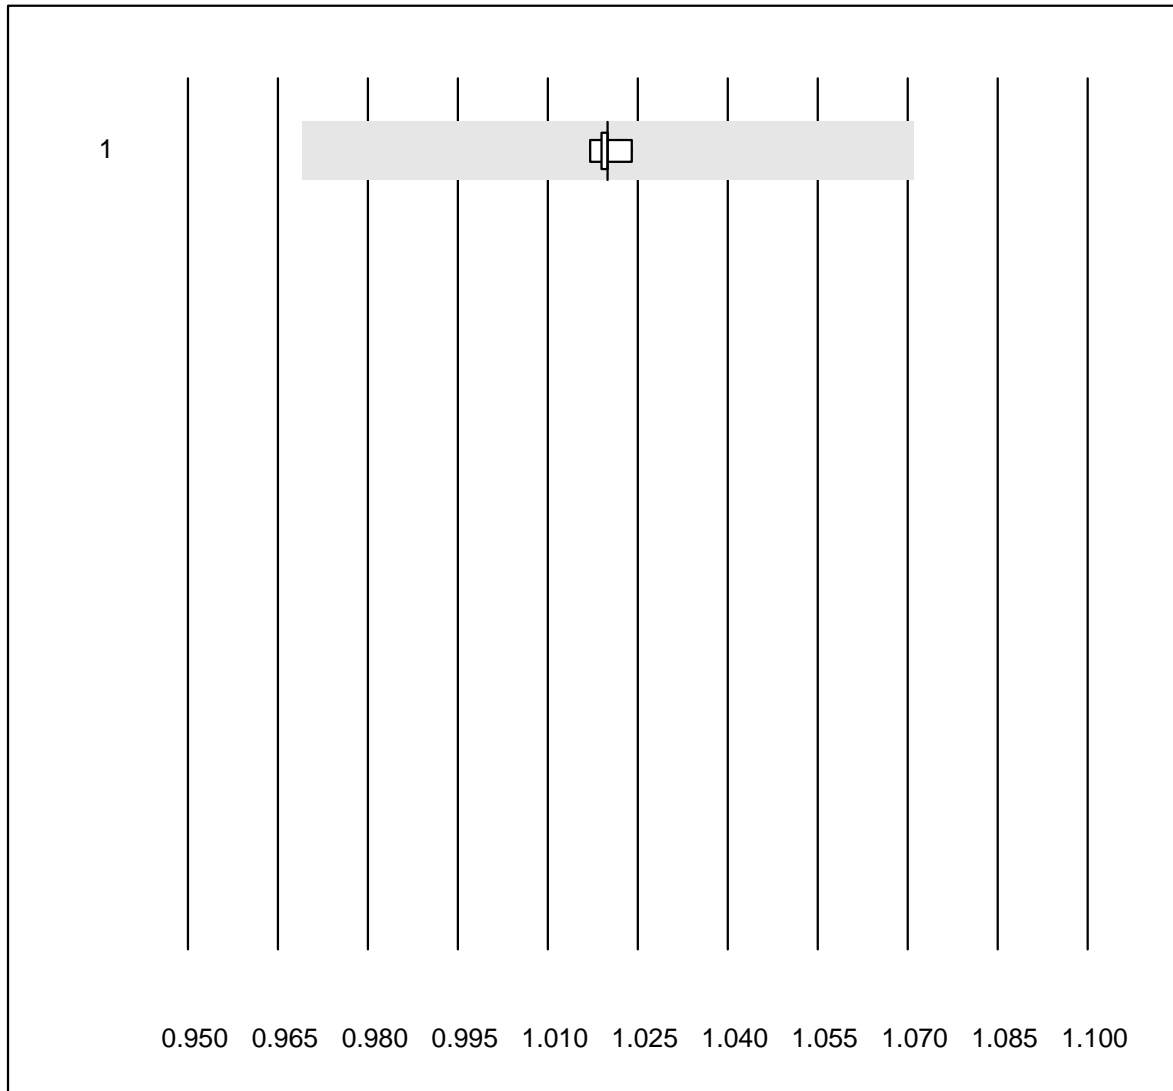


Tolérance QUALAB : 5 %

Gravité spécifique - urine ()

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Refraktometer	7	100.0	0.0	0.0	1.020	0.2	e

INR CoaguChek

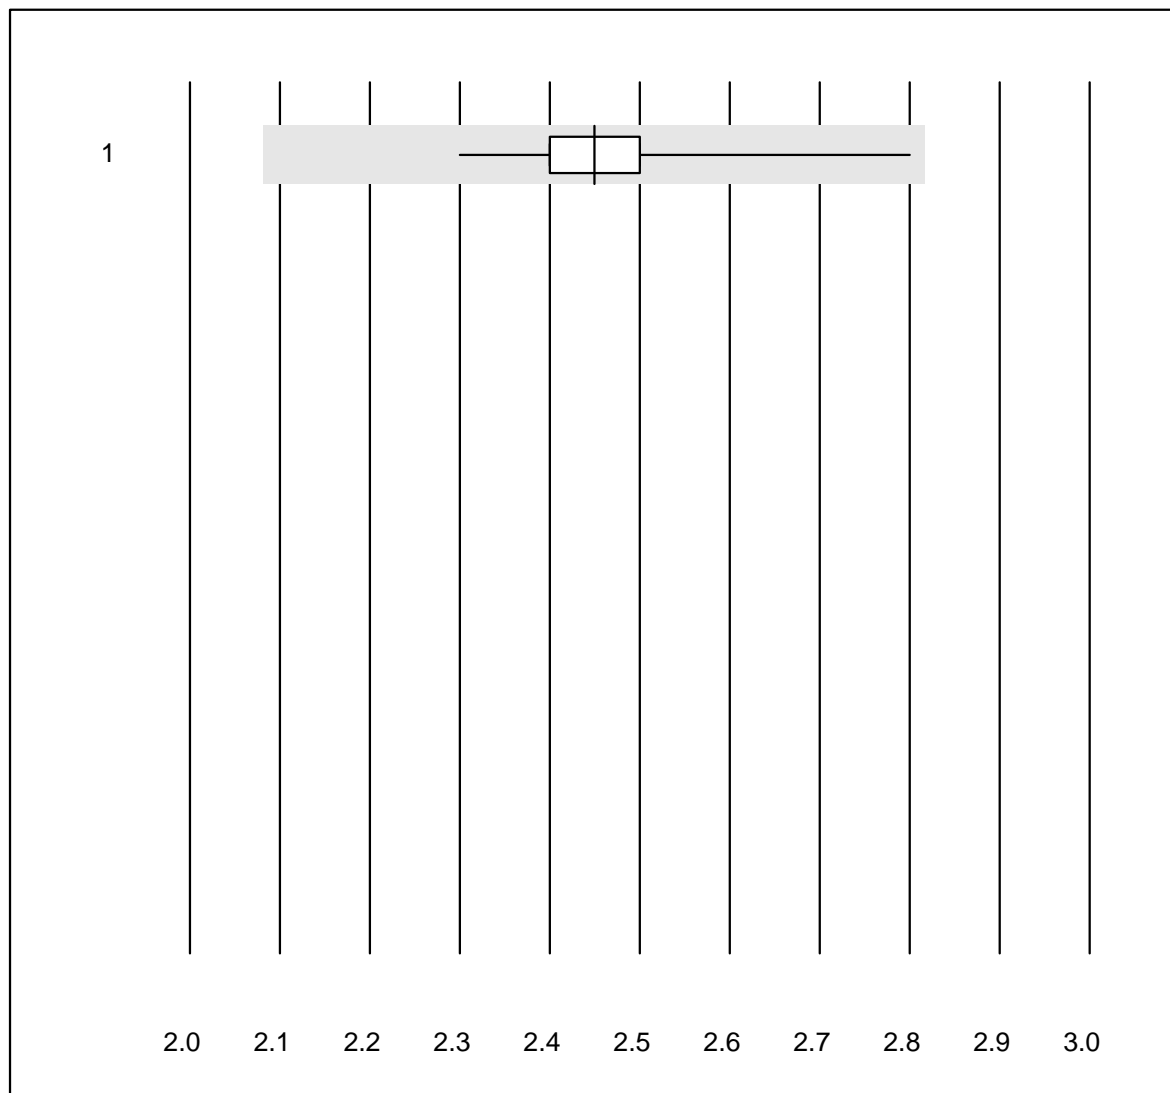


Tolérance QUALAB : 15 %

INR CoaguChek ()

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	CoaguChek Pro II	62	100.0	0.0	0.0	2.4	3.1	e

Quick OA

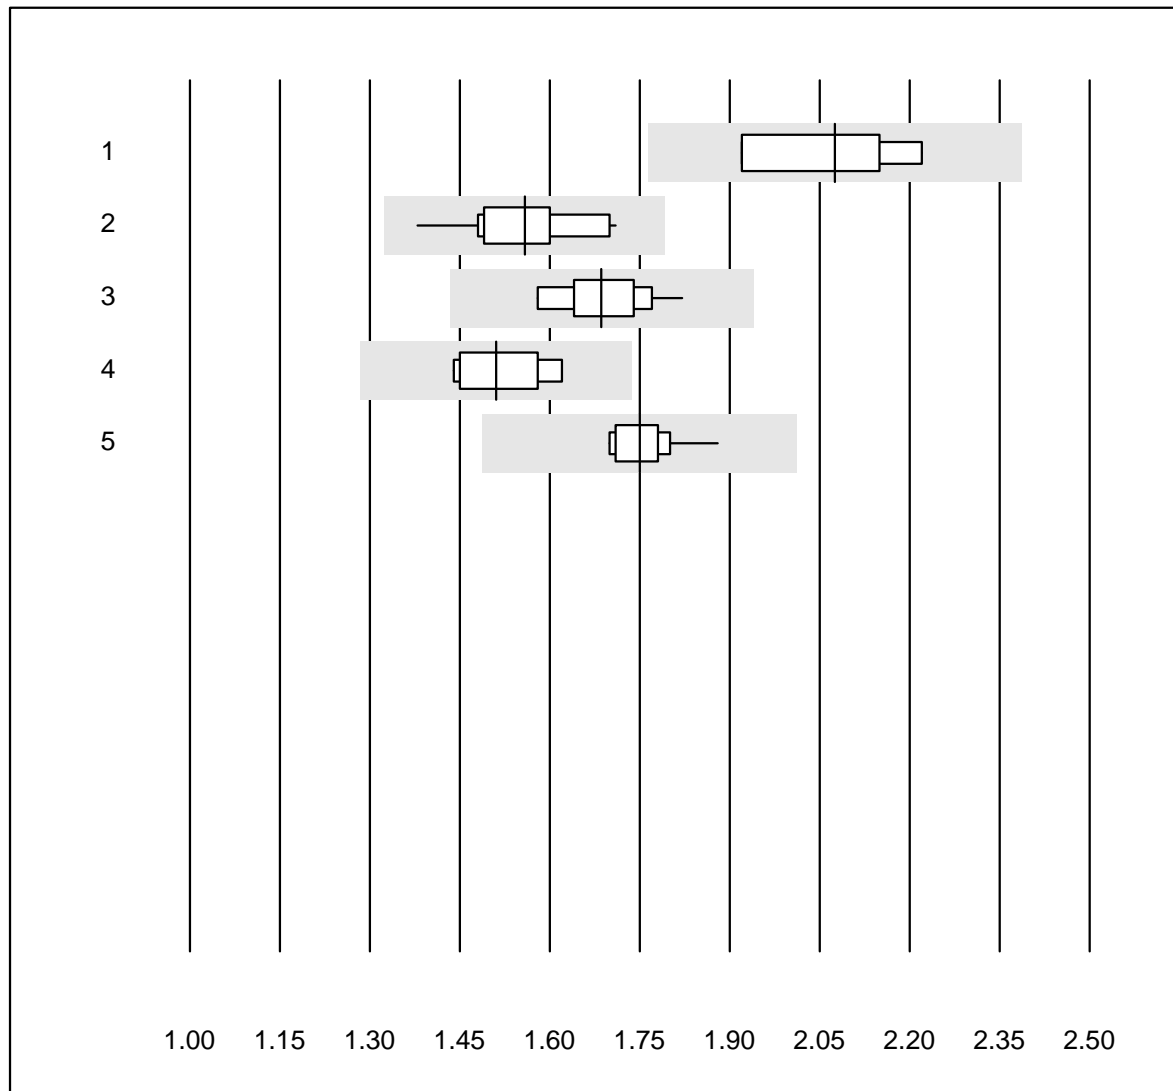


Tolérance QUALAB : 15 %

Quick OA ()

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Neoplastin Plus	4	100.0	0.0	0.0	2.08	6.6	e*
2	Innovin	15	100.0	0.0	0.0	1.56	5.6	e
3	Recombiplastin 2G	10	100.0	0.0	0.0	1.69	4.6	e
4	Eurolyser	6	100.0	0.0	0.0	1.51	5.1	e*
5	Neoplastin R	10	100.0	0.0	0.0	1.75	3.3	e

Fibrinogène OA

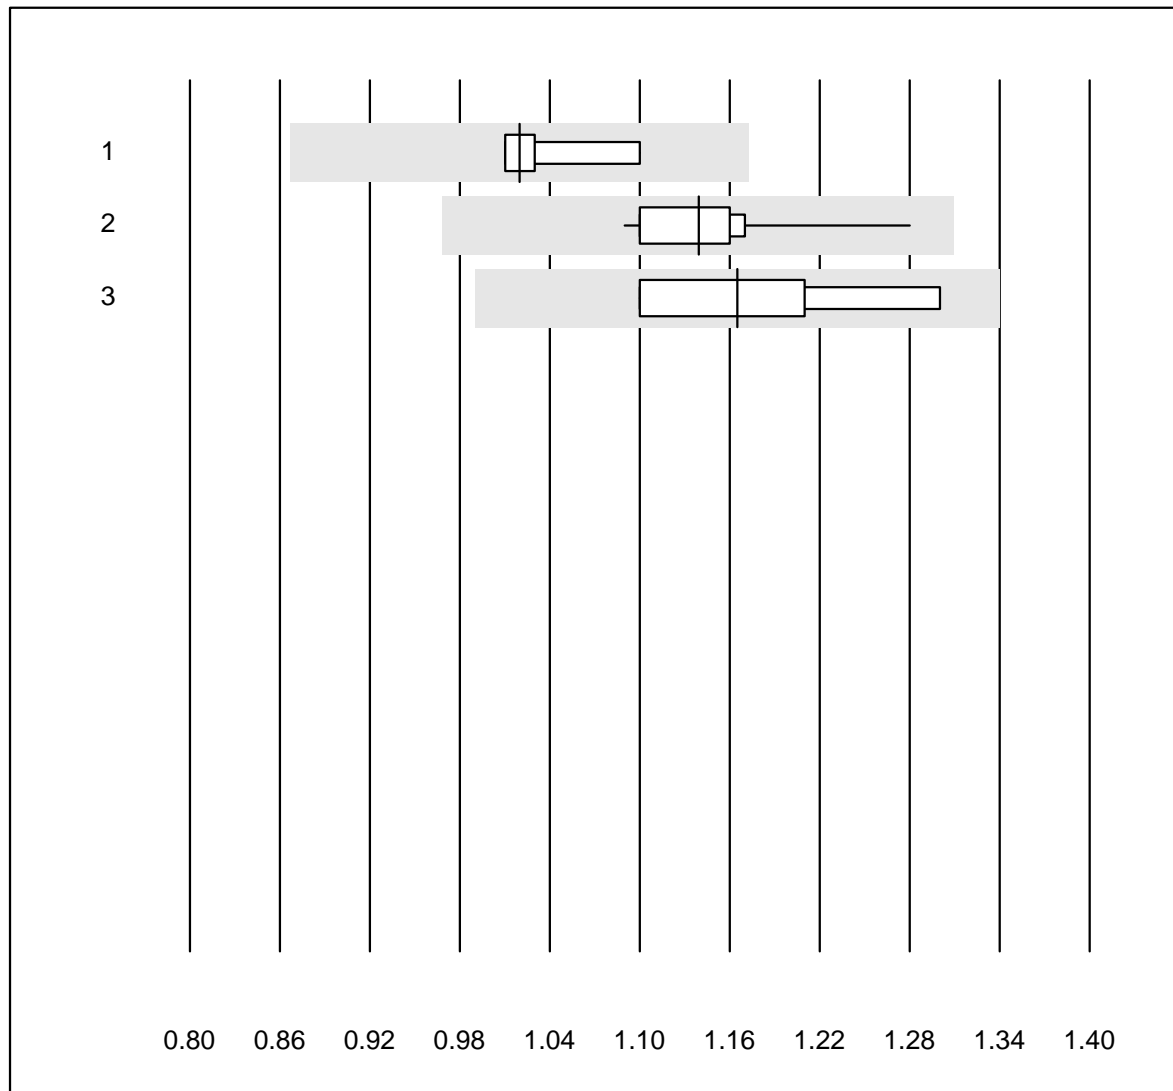


Tolérance QUALAB : 15 %

Fibrinogène OA (g/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Siemens Thrombin	4	100.0	0.0	0.0	1.02	4.1	e*
2	Stago/STA	11	100.0	0.0	0.0	1.14	4.8	e
3	Fibrinogen Q.F.A.	4	100.0	0.0	0.0	1.17	7.8	e*

aPTT OA

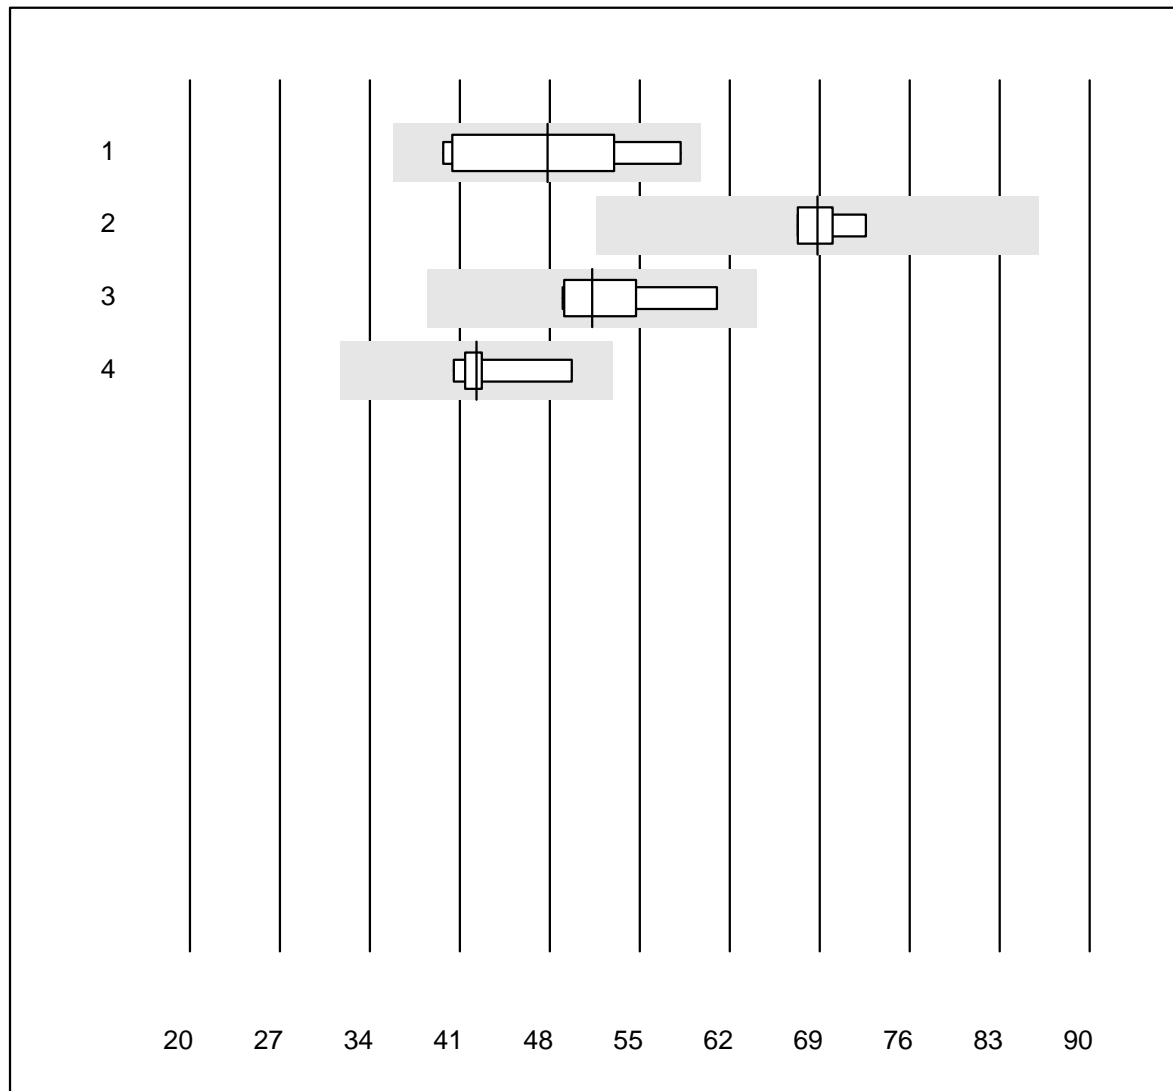


Tolérance QUALAB : 25 %

aPTT OA (Sek)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Actin FS	8	100.0	0.0	0.0	47.8	13.5	e*
2	Pathromtin SL	4	100.0	0.0	0.0	68.9	3.5	e
3	Stago/STA	8	100.0	0.0	0.0	51.3	7.7	e
4	aPTT-SP	8	100.0	0.0	0.0	42.3	6.7	e

Quick N

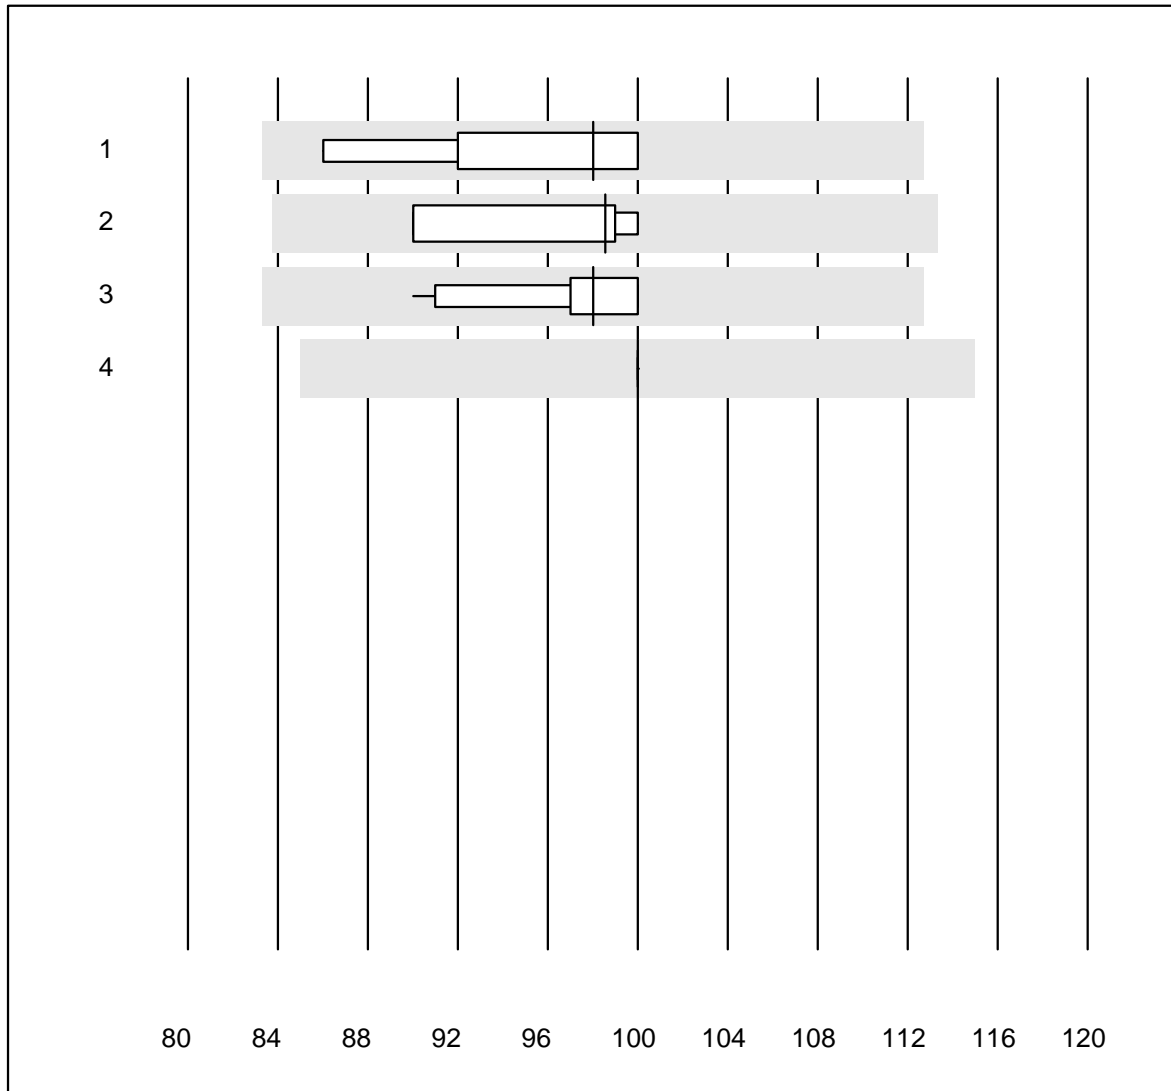


Tolérance QUALAB : 15 %

Quick N (%)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Neoplastin R	7	100.0	0.0	0.0	98	5.4	e*
2	Neoplastin Plus	4	100.0	0.0	0.0	99	4.7	e*
3	Innovin	11	100.0	0.0	0.0	98	3.9	e
4	Recombiplastin 2G	11	100.0	0.0	0.0	100	0.0	e

Fibrinogen N

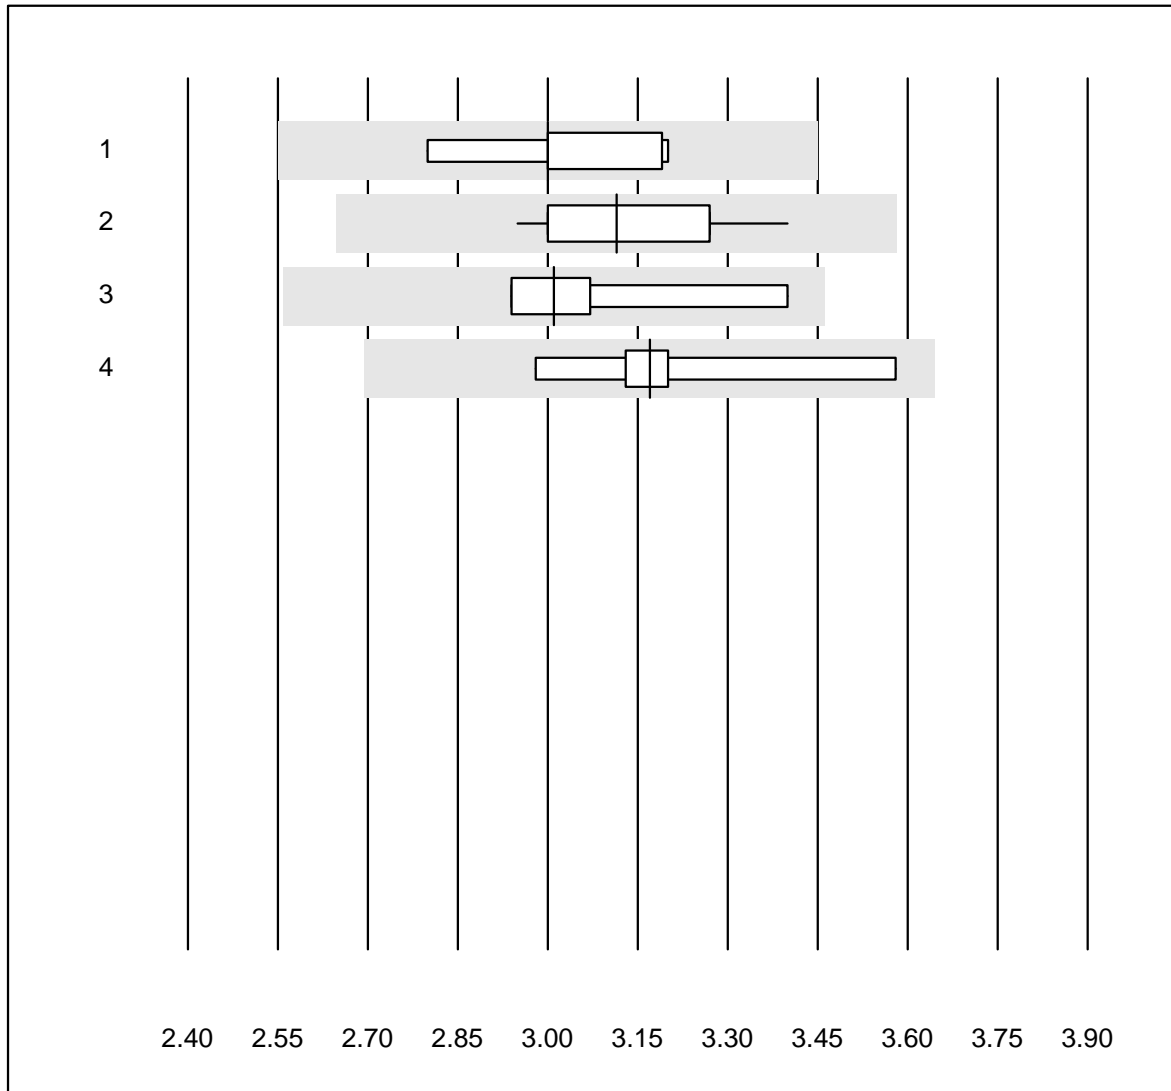


Tolérance QUALAB : 15 %

Fibrinogen N (g/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Siemens Thrombin	6	83.3	0.0	16.7	3.00	5.4	e*
2	Stago/STA	12	100.0	0.0	0.0	3.11	4.8	e
3	Fibrinogen Q.F.A.	4	100.0	0.0	0.0	3.01	7.0	e*
4	Fib Clauss (IL)	5	100.0	0.0	0.0	3.17	6.9	e*

aPTT N

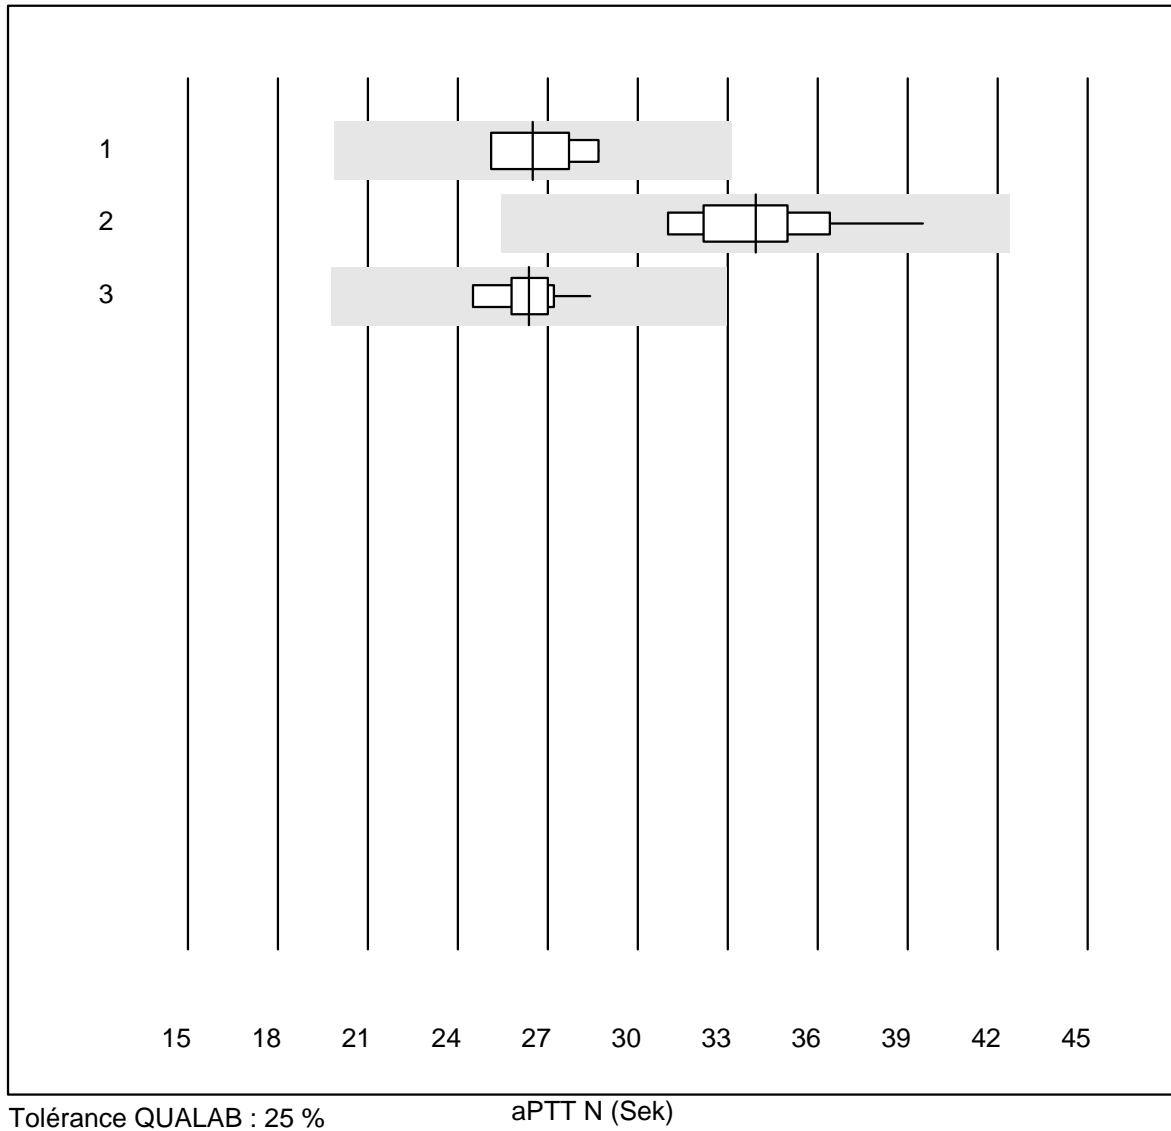


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Actin FS	6	100.0	0.0	0.0	26.5	5.5	e
2 Stago/STA	10	100.0	0.0	0.0	33.9	7.4	e
3 aPTT-SP	10	100.0	0.0	0.0	26.4	4.3	e

Quick H

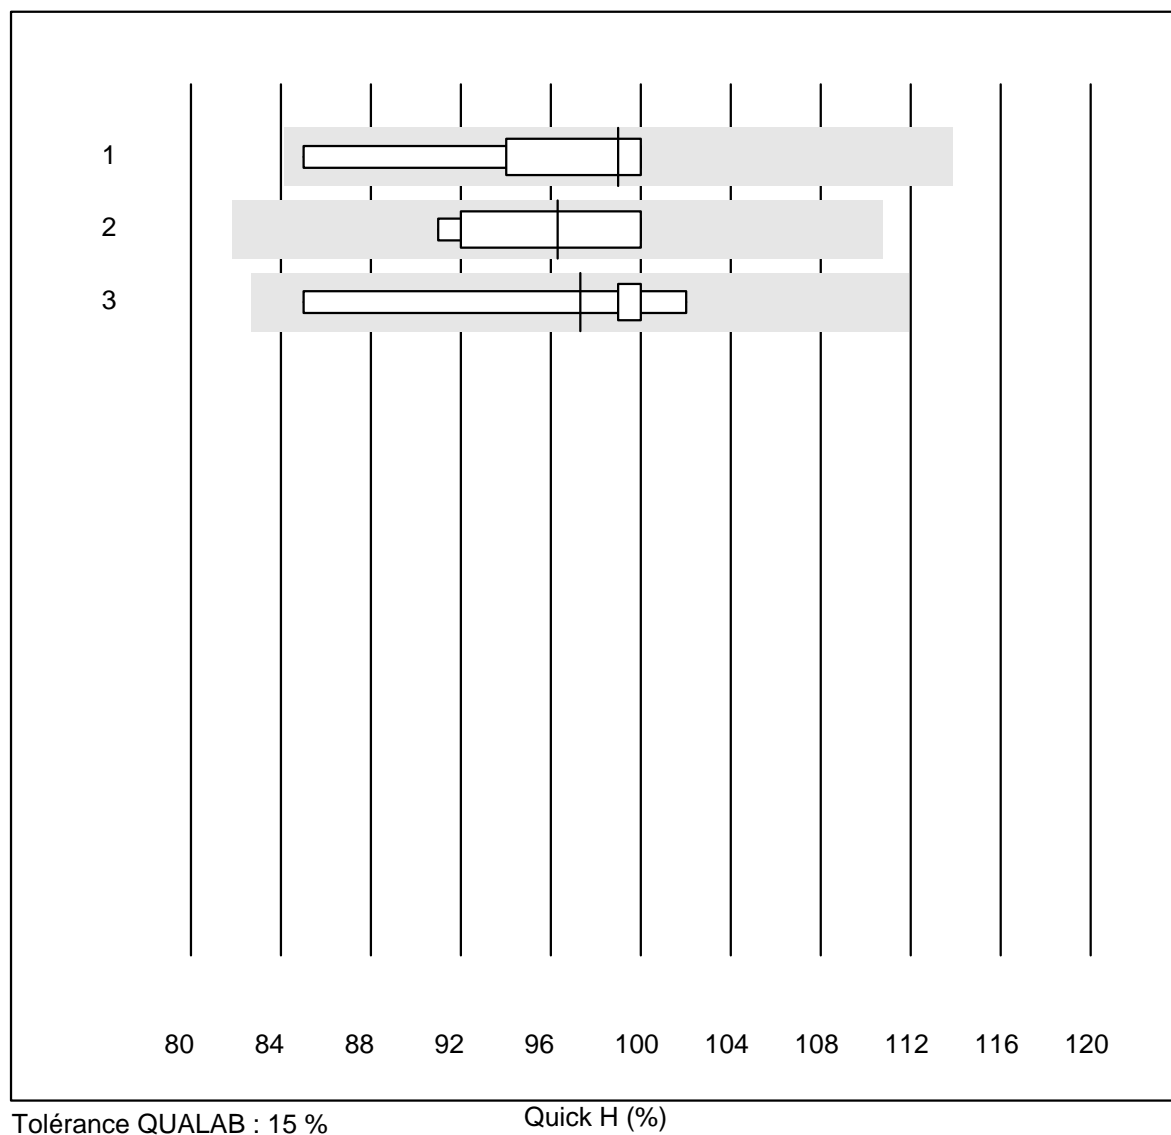


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Neoplastin R	7	100.0	0.0	0.0	99	5.7	e*
2	Innovin	7	100.0	0.0	0.0	96	4.1	e
3	Recombiplastin 2G	10	100.0	0.0	0.0	97	6.5	e*

Fibrinogen H

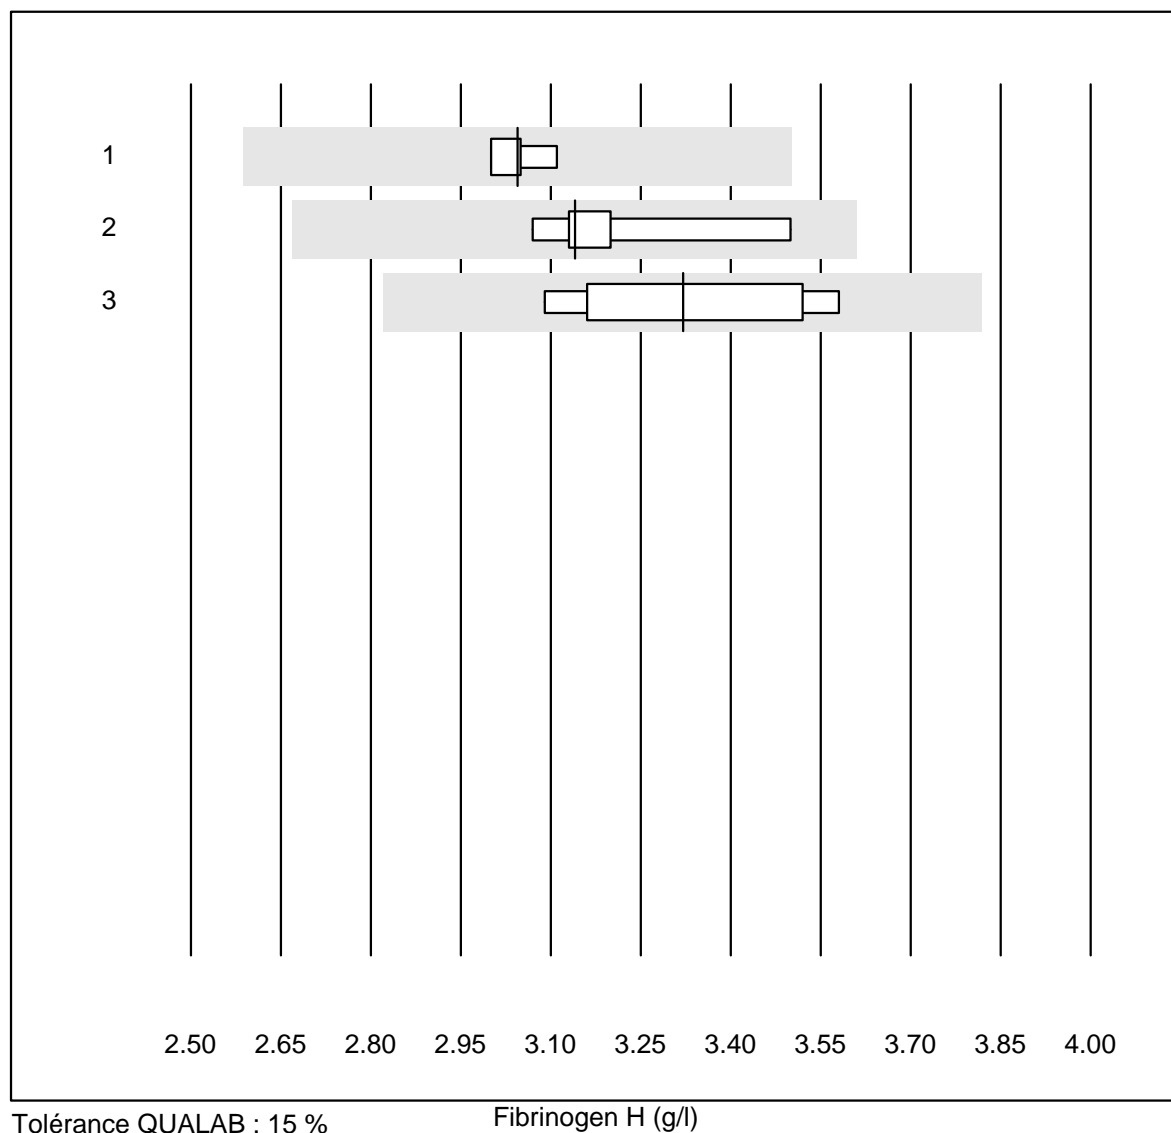


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Siemens Thrombin	4	100.0	0.0	0.0	3.05	1.5	e
2	Stago/STA	9	100.0	0.0	0.0	3.14	4.1	e
3	Fib Clauss (IL)	5	100.0	0.0	0.0	3.32	6.5	e*

aPTT H

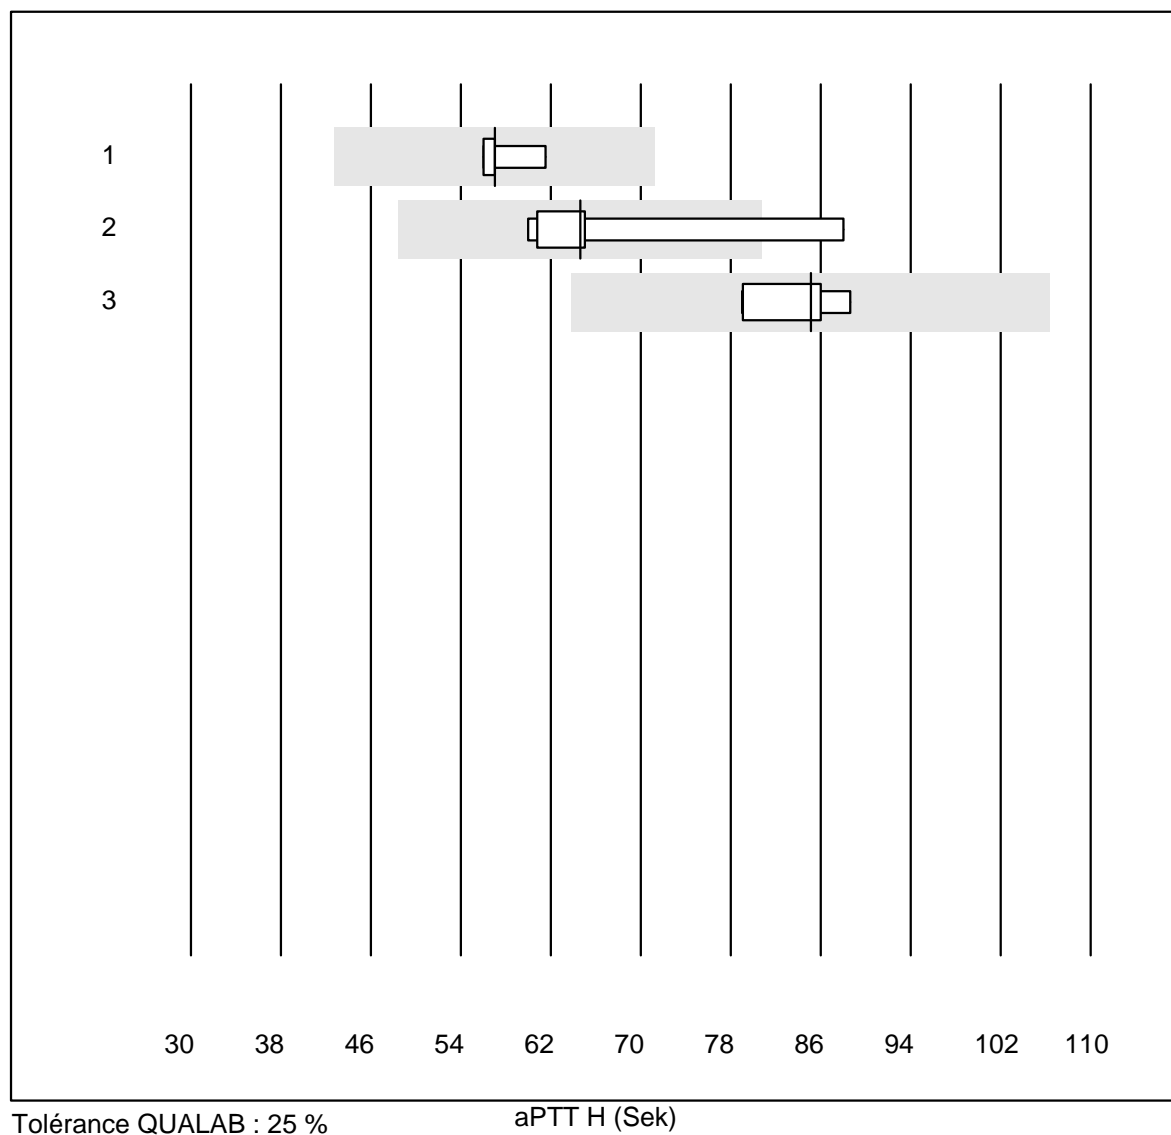


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Actin FS	5	80.0	0.0	20.0	57.0	4.5	e
2	Stago/STA	7	71.4	14.3	14.3	64.6	15.6	e*
3	aPTT-SP	7	85.7	0.0	14.3	85.1	5.1	e

Troponine I

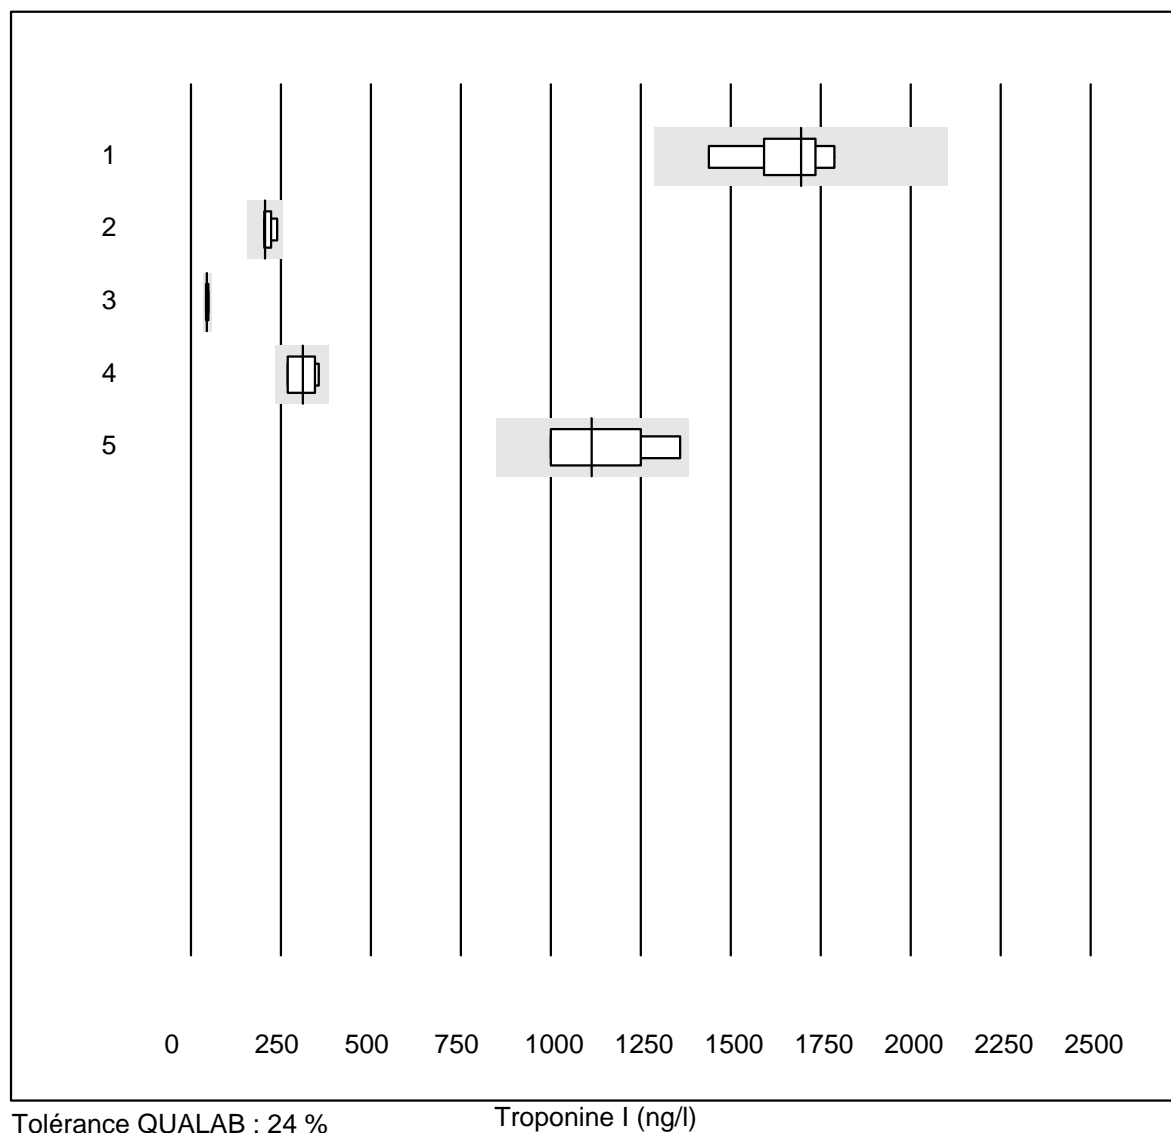

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Vidas	8	100.0	0.0	0.0	1695.5	6.5	e
2	Architect High Sensi	6	100.0	0.0	0.0	206.1	6.6	e
3	AQT 90 FLEX	7	100.0	0.0	0.0	45.0	6.5	e
4	ADVIA Centaur XP/CP	5	80.0	0.0	20.0	310.0	14.9	a
5	Eurolyser	16	56.2	0.0	43.8	1114.4	13.0	e*

Troponine T

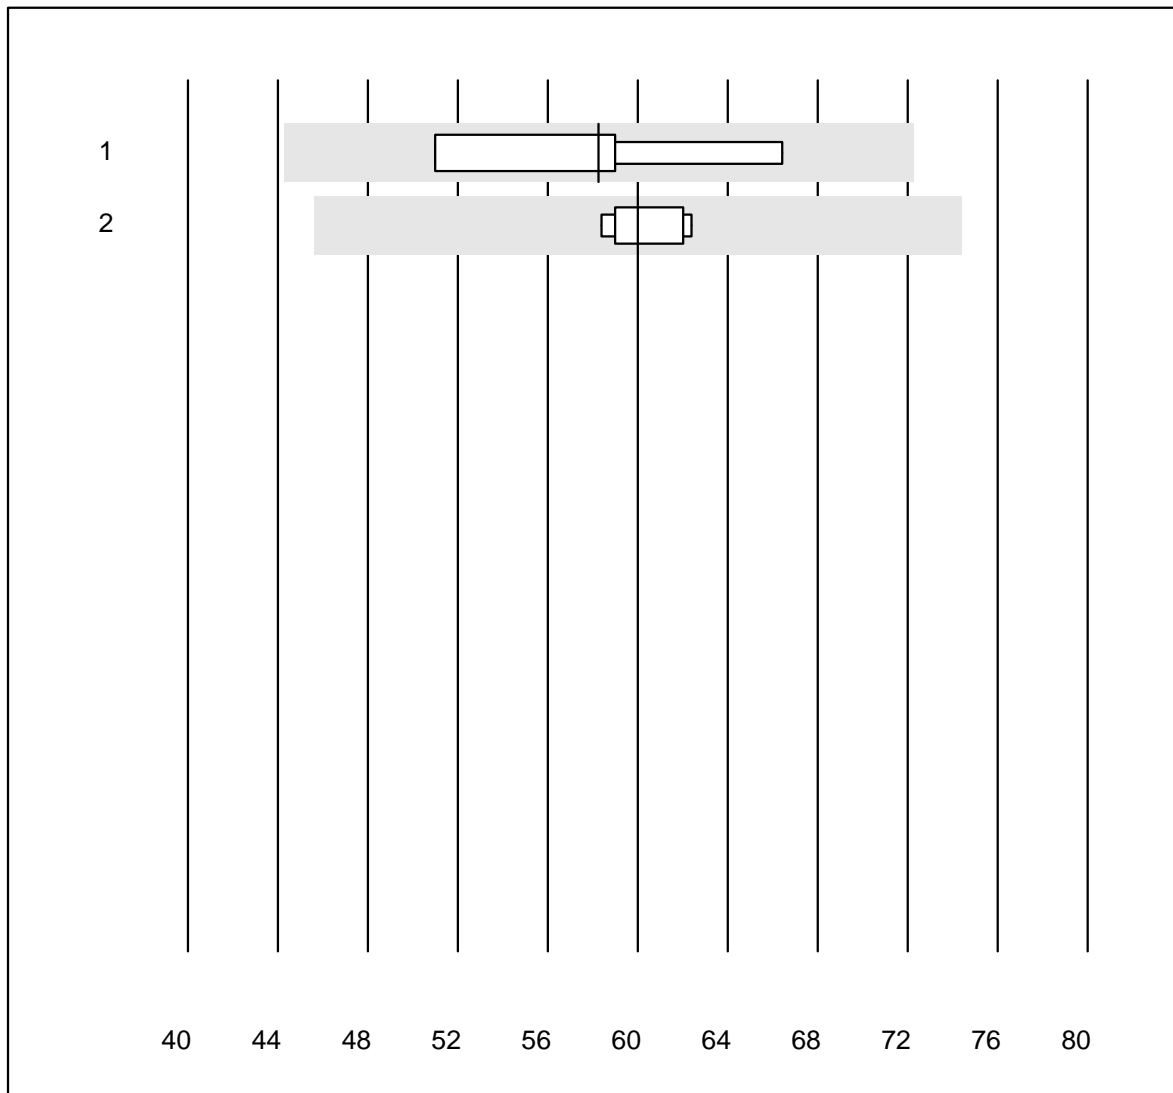


Tolérance QUALAB : 24 %

Troponine T (ng/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas hs	4	100.0	0.0	0.0	58.25	10.8	e*
2	Cobas hs STAT	6	100.0	0.0	0.0	60.00	2.6	e

Myoglobine

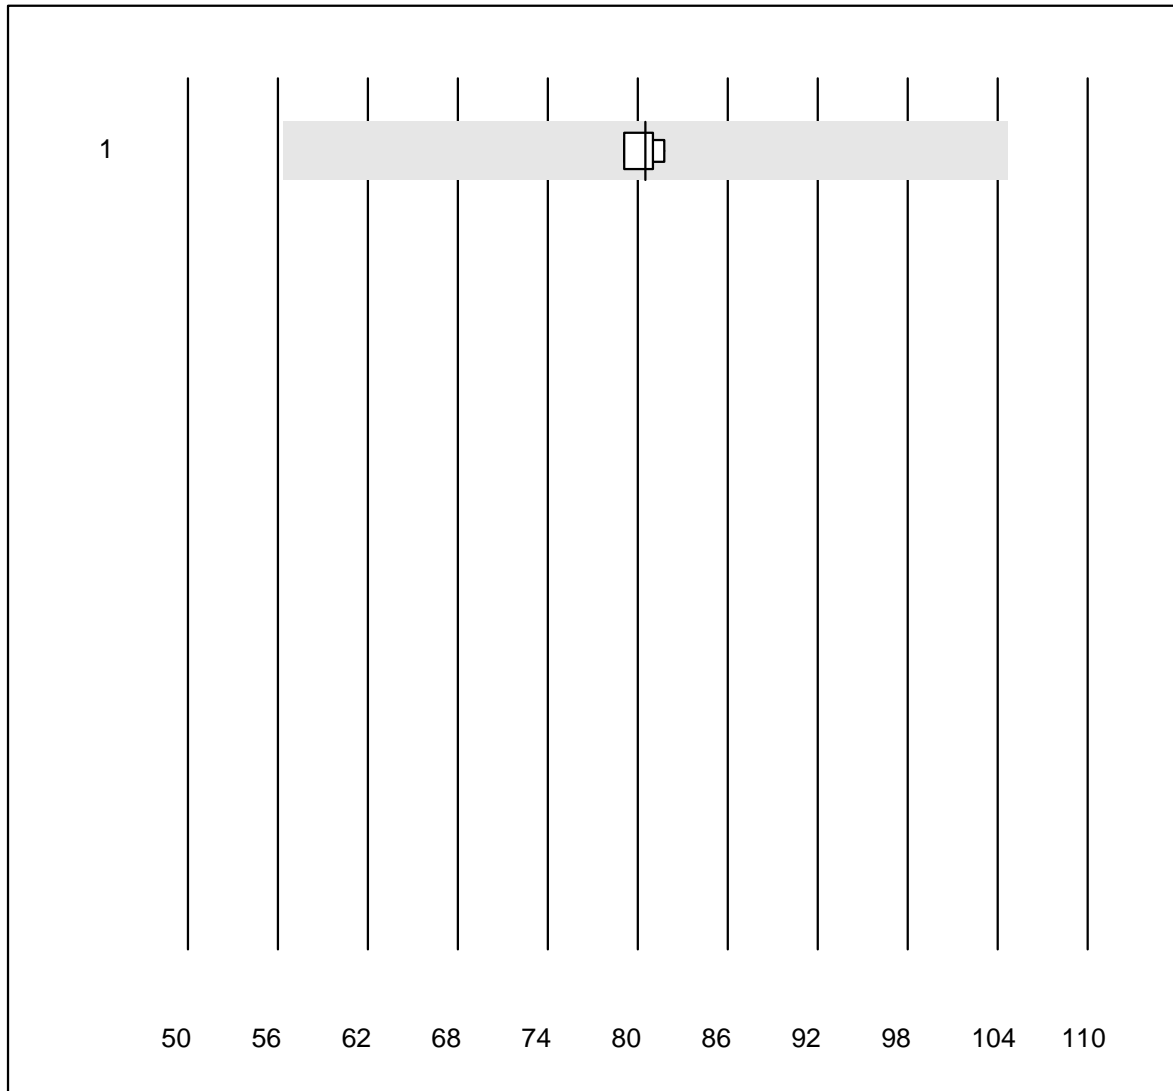


Tolérance QUALAB : 30 %

Myoglobine (µg/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	4	100.0	0.0	0.0	80.5	1.5	e

D-Dimères

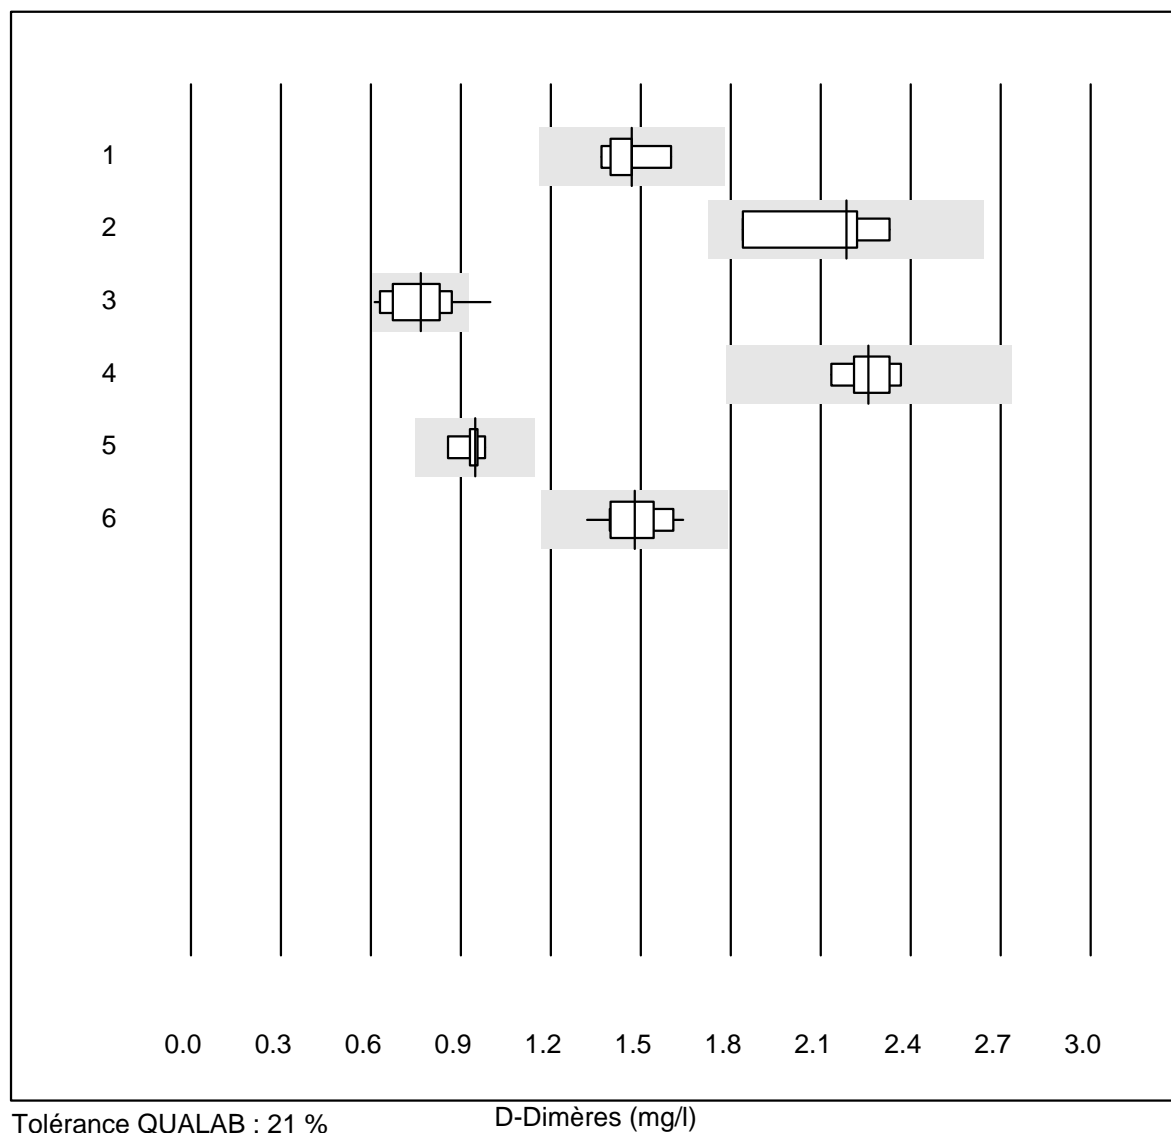


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 STA Liatest	9	88.9	0.0	11.1	1.47	5.1	e
2 Siemens Innovance	4	100.0	0.0	0.0	2.19	9.8	e*
3 Eurolyser	27	85.2	3.7	11.1	0.77	12.8	e
4 ACL	5	100.0	0.0	0.0	2.26	4.1	e
5 AQT 90 FLEX	9	100.0	0.0	0.0	0.95	3.8	e
6 Vidas	12	100.0	0.0	0.0	1.48	6.4	e

D-Dimères NC

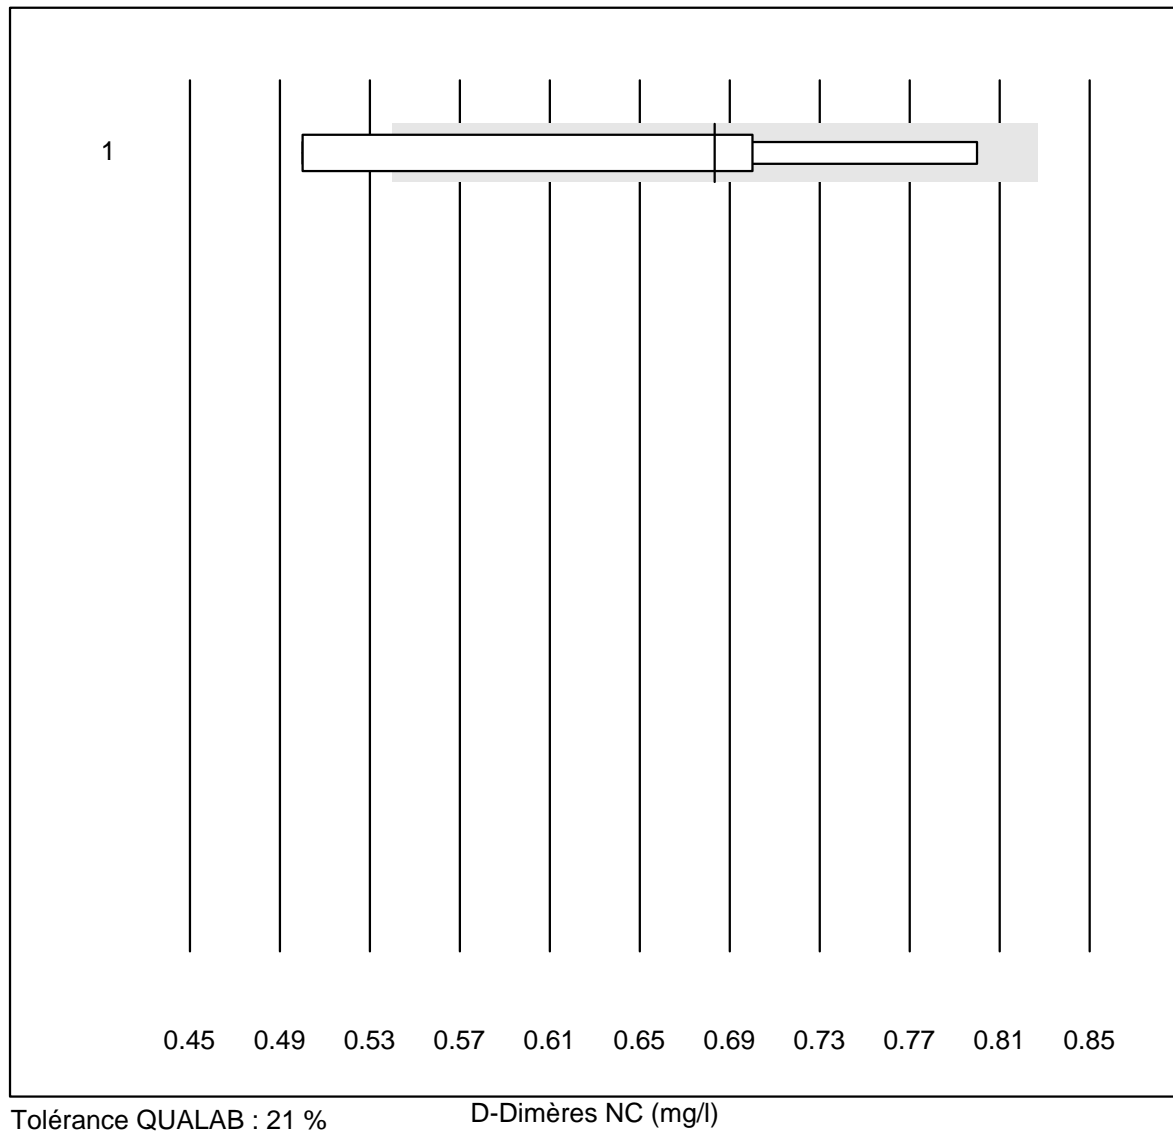

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 NycoCard	23	52.2	17.4	30.4	0.68	17.6	e*

TSH

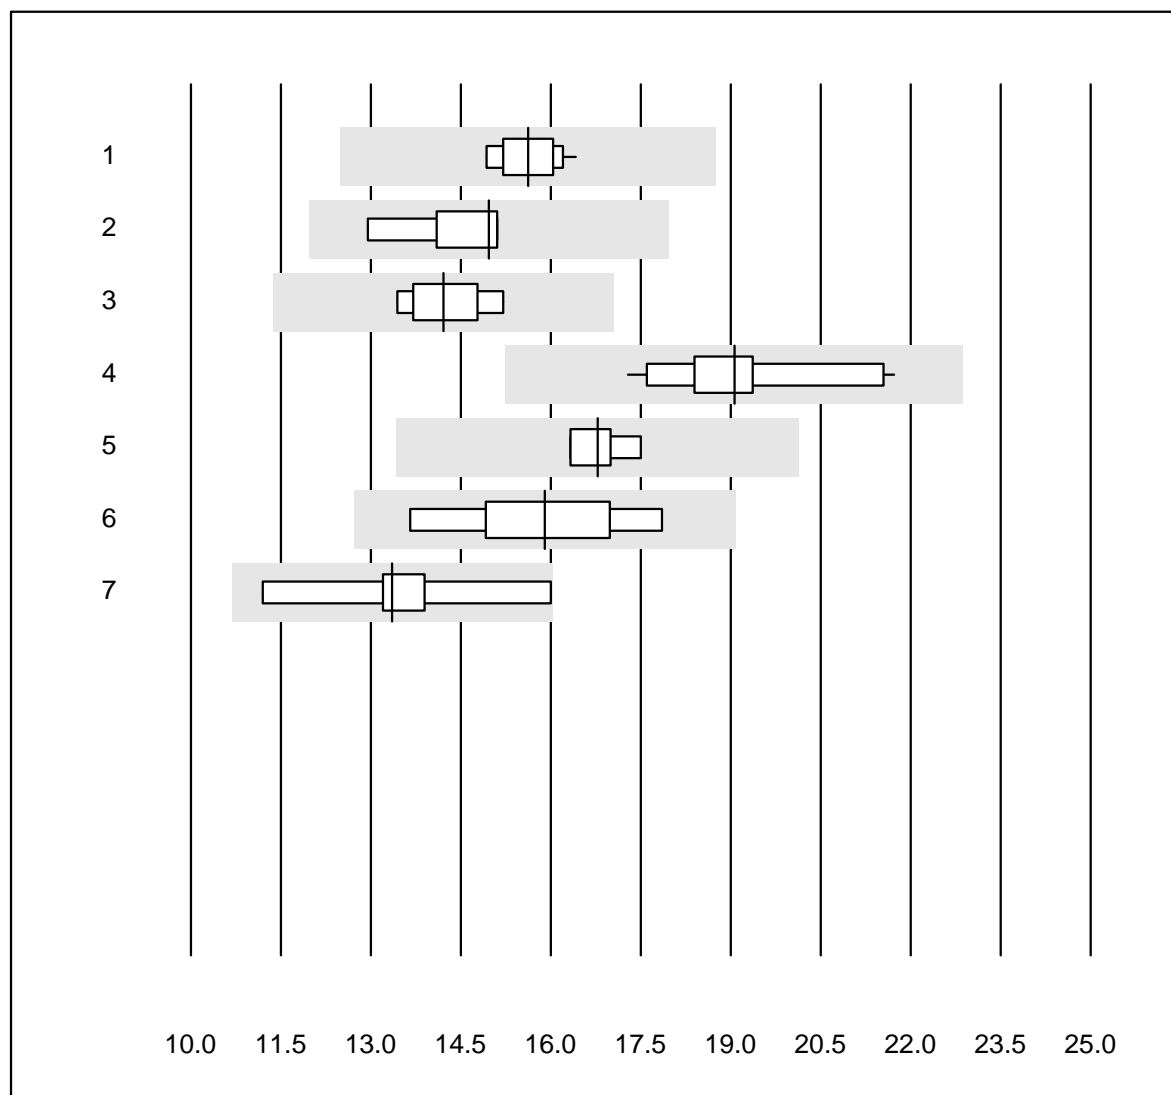


Tolérance QUALAB : 20 %

TSH (mU/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	10	100.0	0.0	0.0	15.6	3.2	e
2	ADVIA Centaur XP/CP	6	100.0	0.0	0.0	15.0	6.0	e*
3	Architect	8	100.0	0.0	0.0	14.2	4.4	e
4	Vidas	13	100.0	0.0	0.0	19.1	7.2	e
5	Dimension	4	100.0	0.0	0.0	16.8	3.1	e
6	AFIAS	7	100.0	0.0	0.0	15.9	8.9	e*
7	Qualigen	6	83.3	0.0	16.7	13.4	12.7	e*

T4

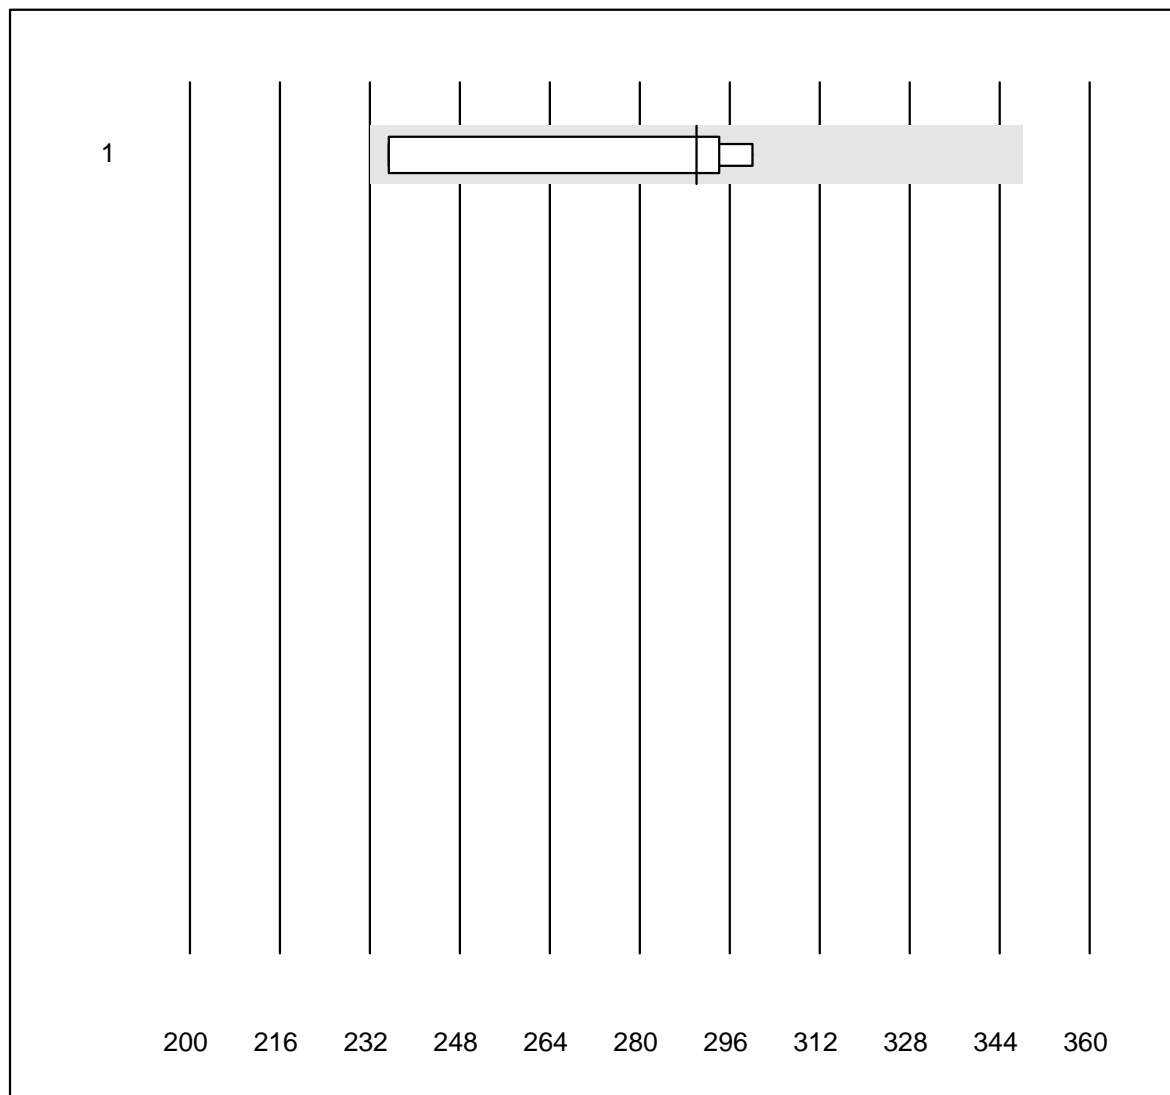


Tolérance QUALAB : 20 %

T4 (nmol/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	290	10.6	e*

FT3

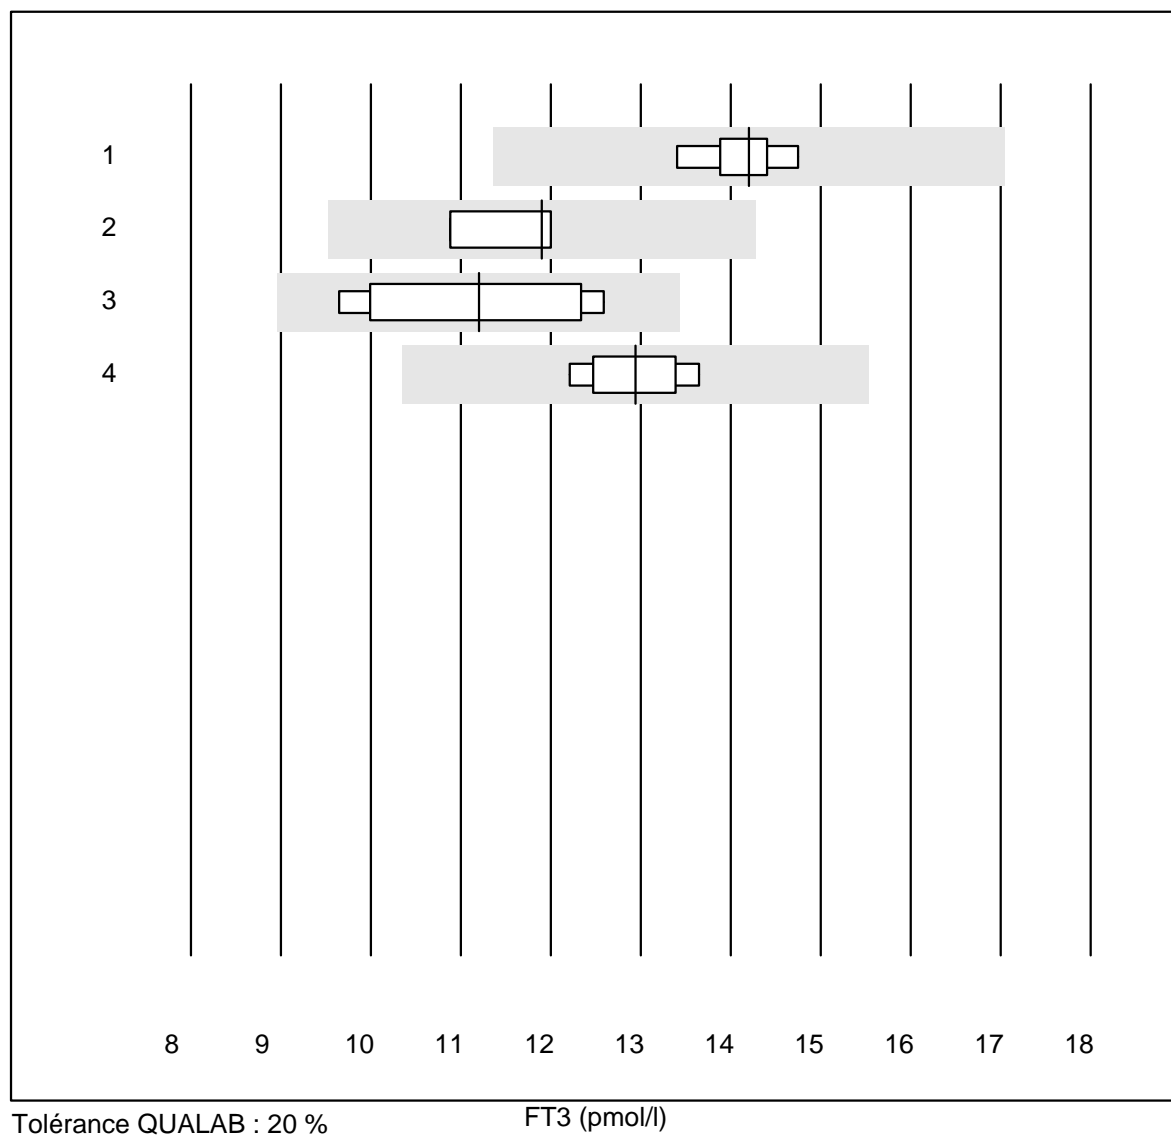


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	9	100.0	0.0	0.0	14.2	3.0	e
2	ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	11.9	4.6	e
3	Architect	7	100.0	0.0	0.0	11.2	10.4	e*
4	Vidas	6	100.0	0.0	0.0	12.9	4.3	e

FT4

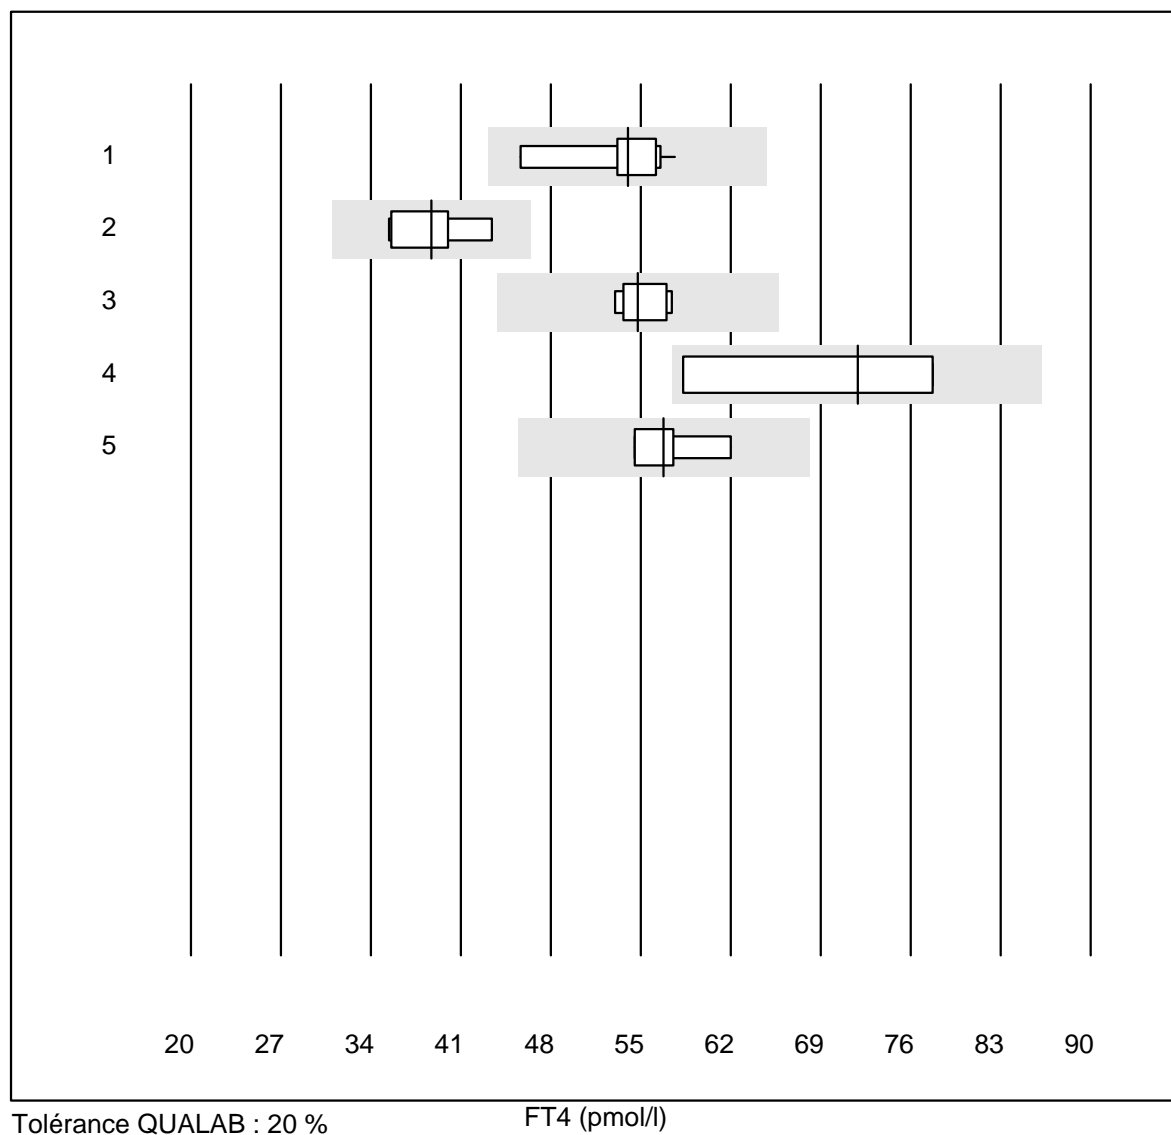

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	10	100.0	0.0	0.0	54.0	6.2	e
2 Architect	8	100.0	0.0	0.0	38.7	7.8	e*
3 Vidas	7	100.0	0.0	0.0	54.8	3.2	e
4 Qualigen	4	100.0	0.0	0.0	71.9	13.6	e*
5 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	56.8	5.6	e*

Testostérone

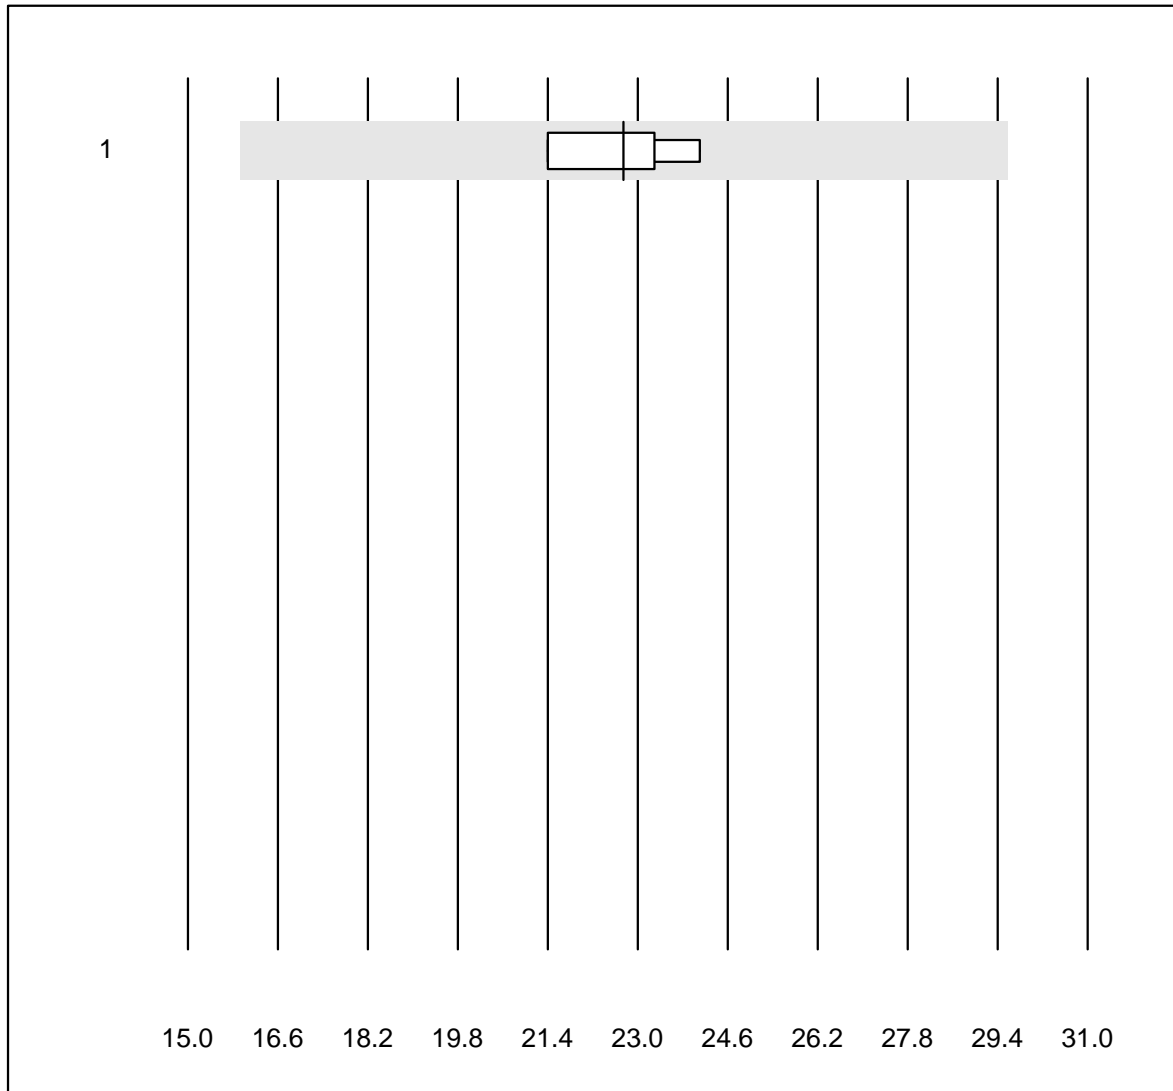


Tolérance QUALAB : 30 %

Testostérone (nmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	23	5.2	e

Cortisol

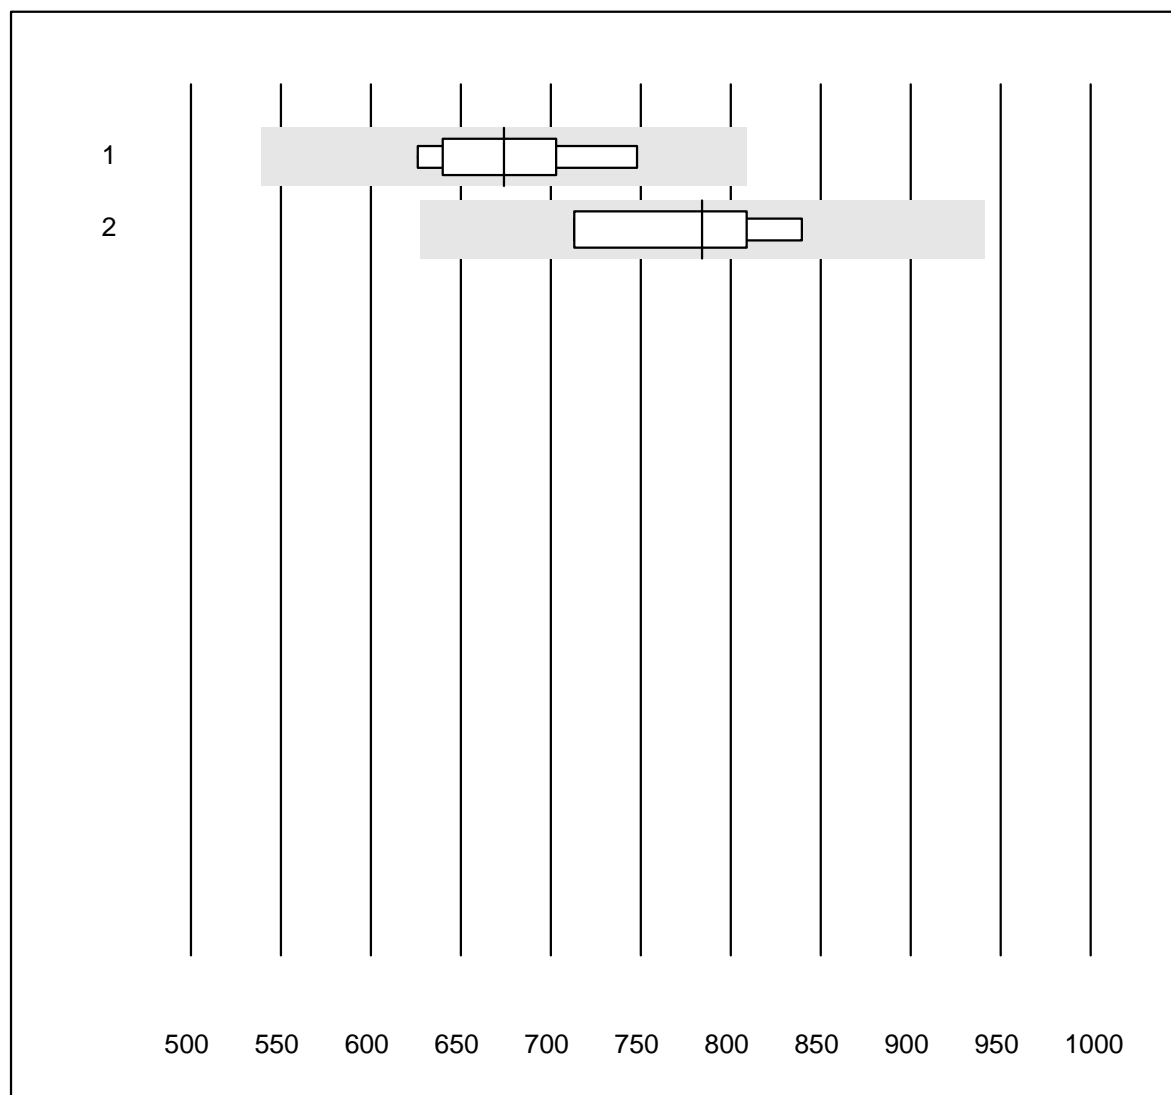


Tolérance QUALAB : 20 %

Cortisol (nmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	6	100.0	0.0	0.0	674	6.8	a
2	ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	784	7.3	a

Luteinisierendes Hormon

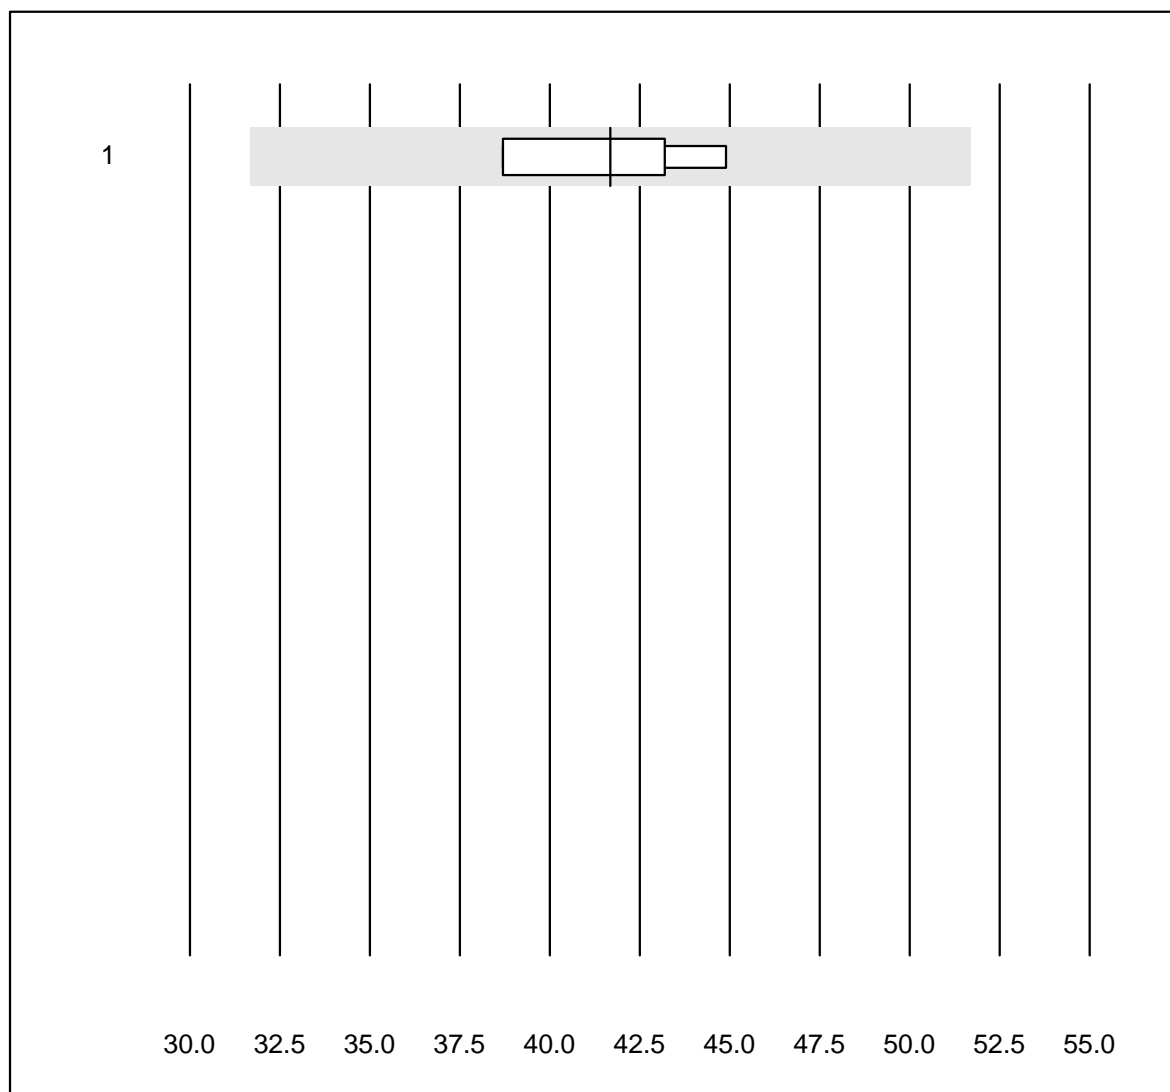


Tolérance QUALAB : 24 %

Luteinisierendes Hormon (U/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	41.7	7.7	a


Follikelstimulierendes Hormon

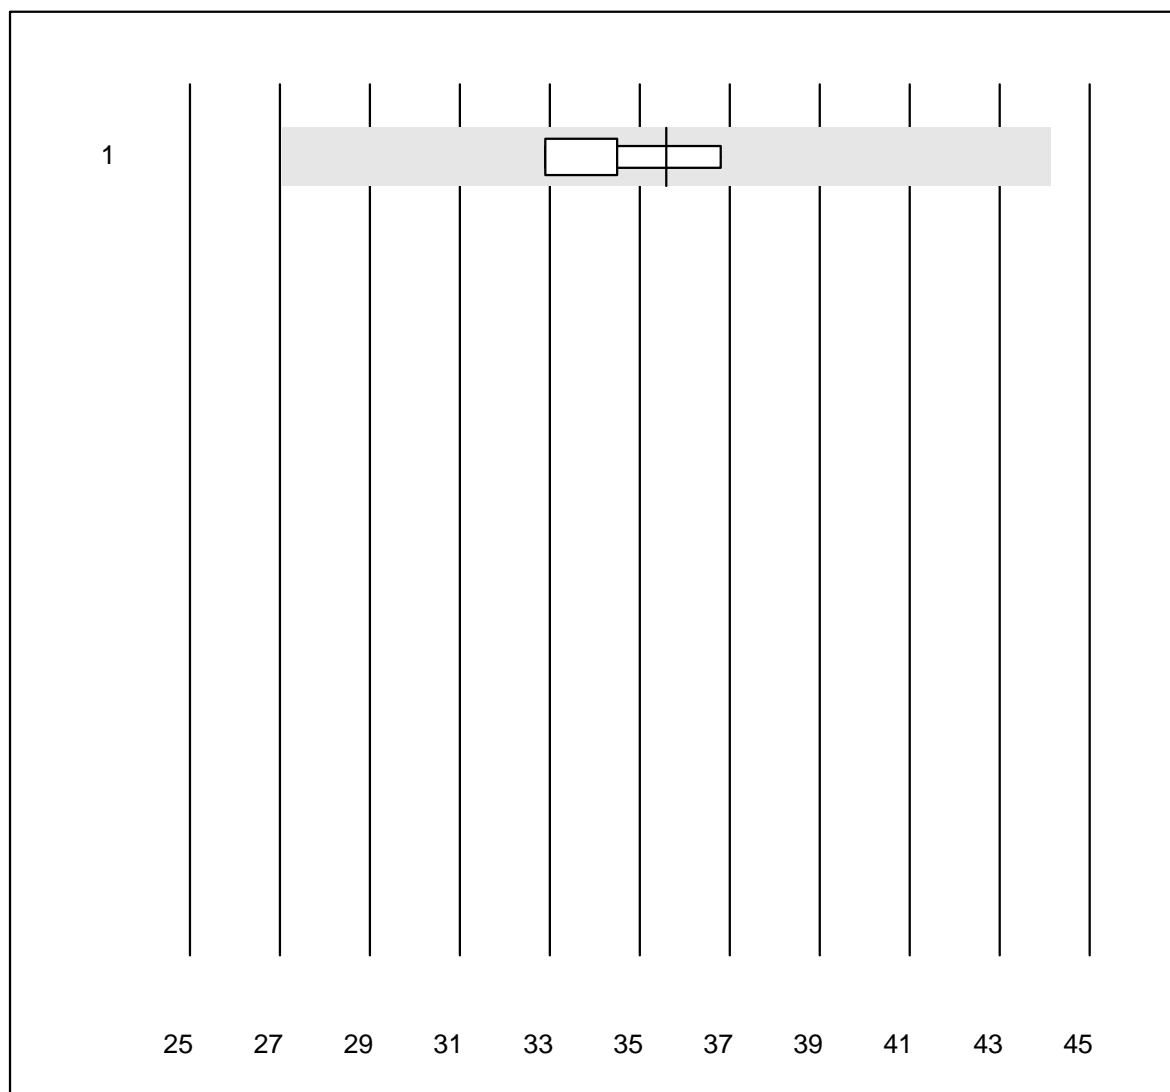

Tolérance QUALAB : 24 % Follikelstimulierendes Hormon (U/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	35.6	4.8	a

Prolaktin (PRL)

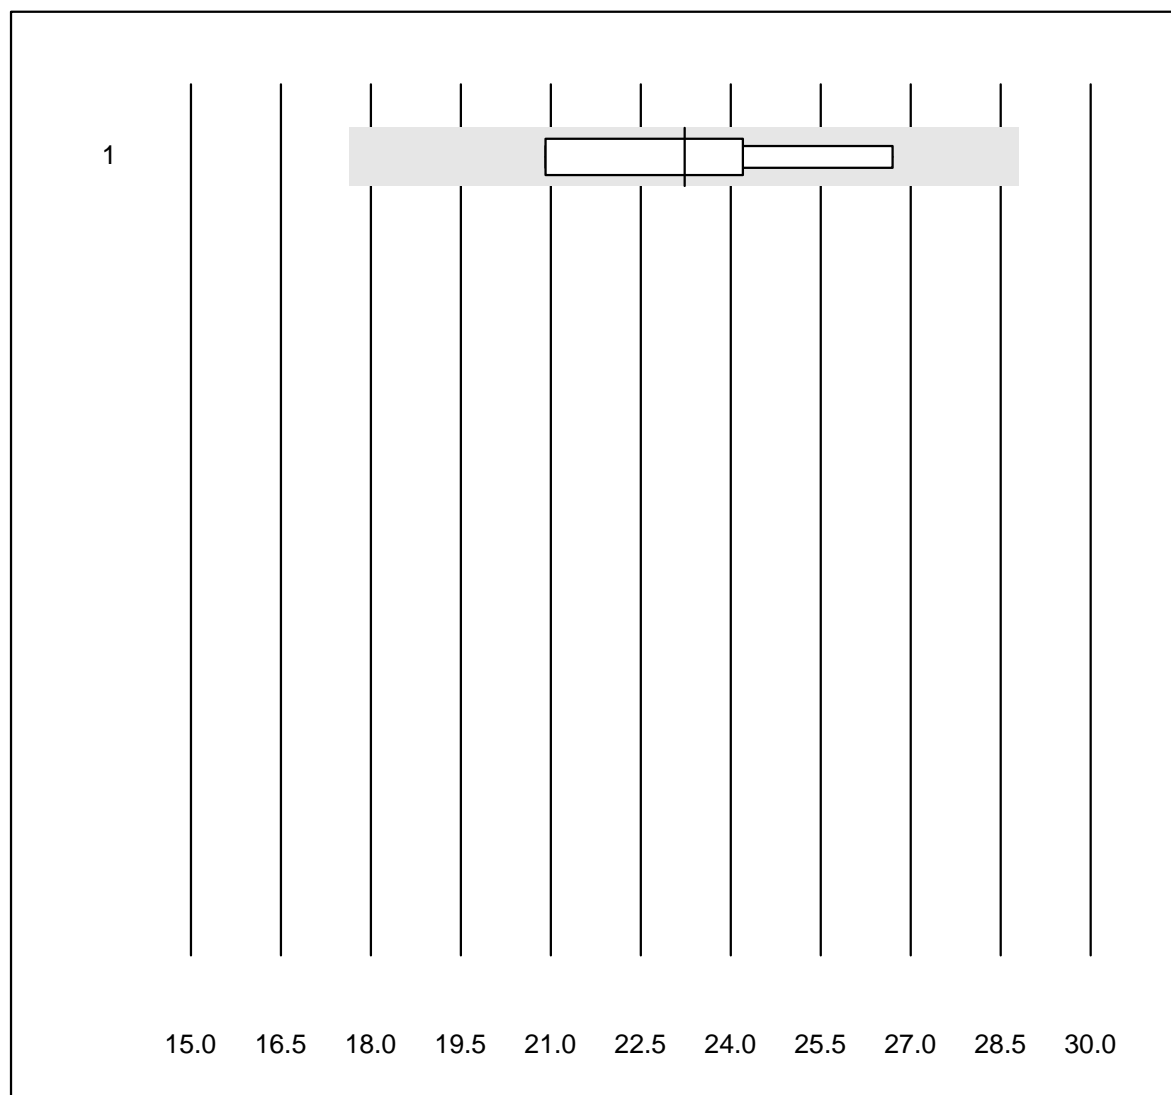


Tolérance QUALAB : 24 %

Prolaktin (PRL) (µg/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	23.2	10.7	e*

Troponine T CR

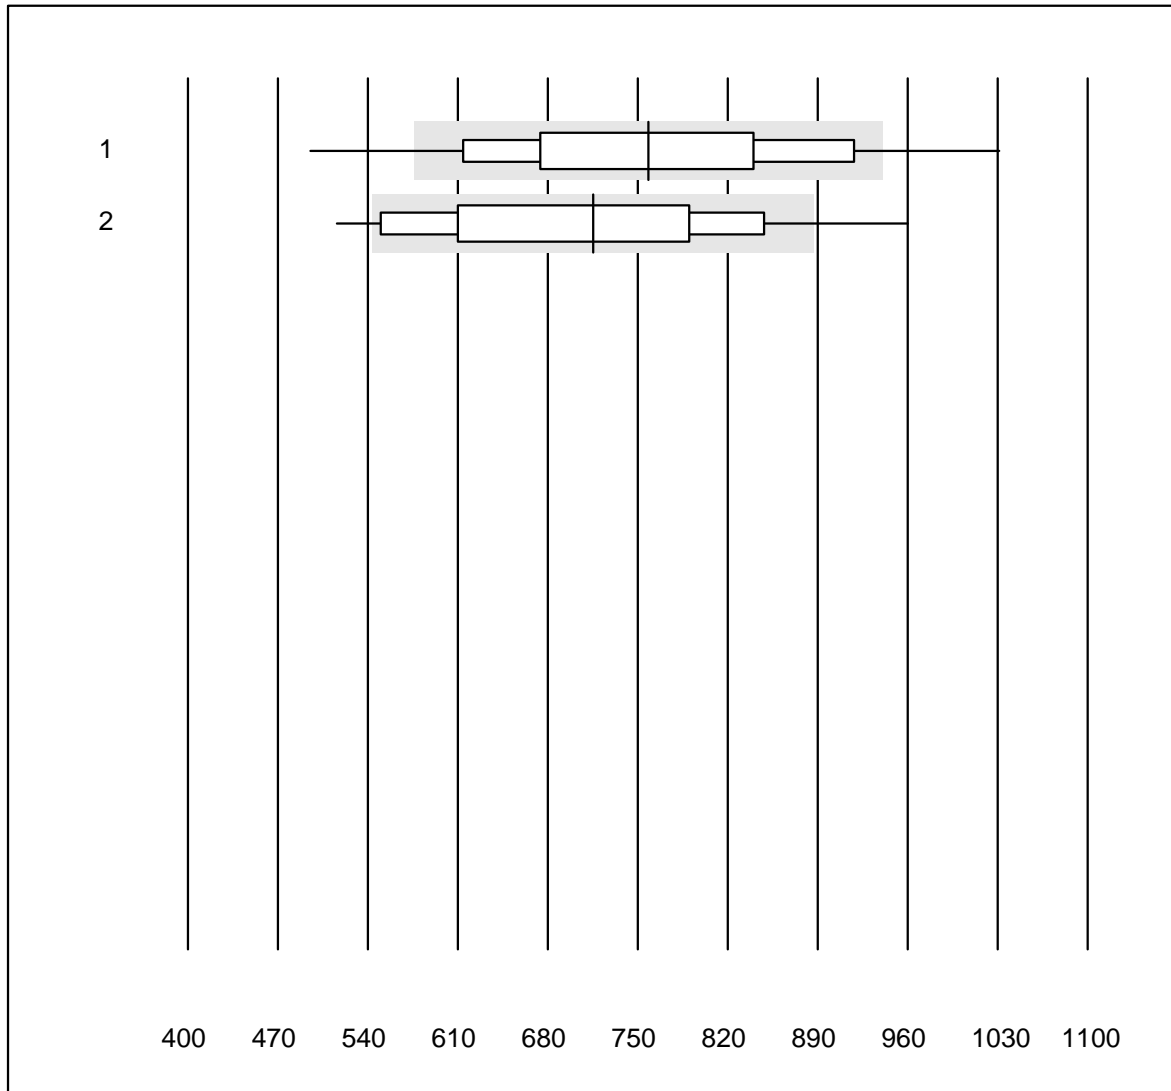


Tolérance QUALAB : 24 %

Troponine T CR (ng/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas h 232	910	84.8	11.6	3.6	758.50	15.1	e
2	Cardiac Reader	42	80.9	14.3	4.8	715.48	16.5	e

Troponin I WB

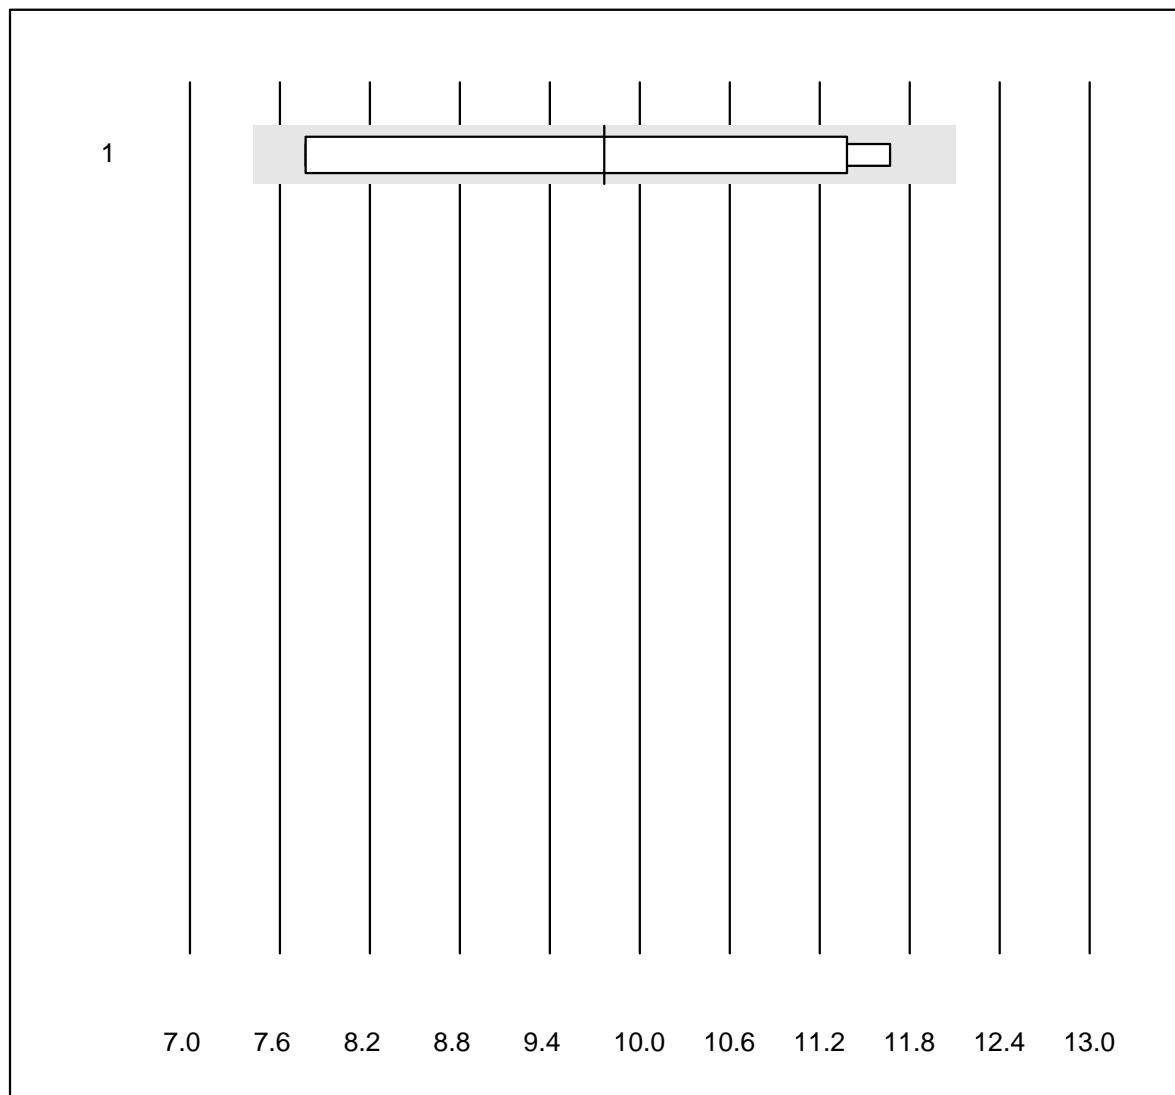


Tolérance QUALAB : 24 %

Troponin I WB (ng/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 iStat	4	100.0	0.0	0.0	9.77	21.2	e*

D-Dimères CR

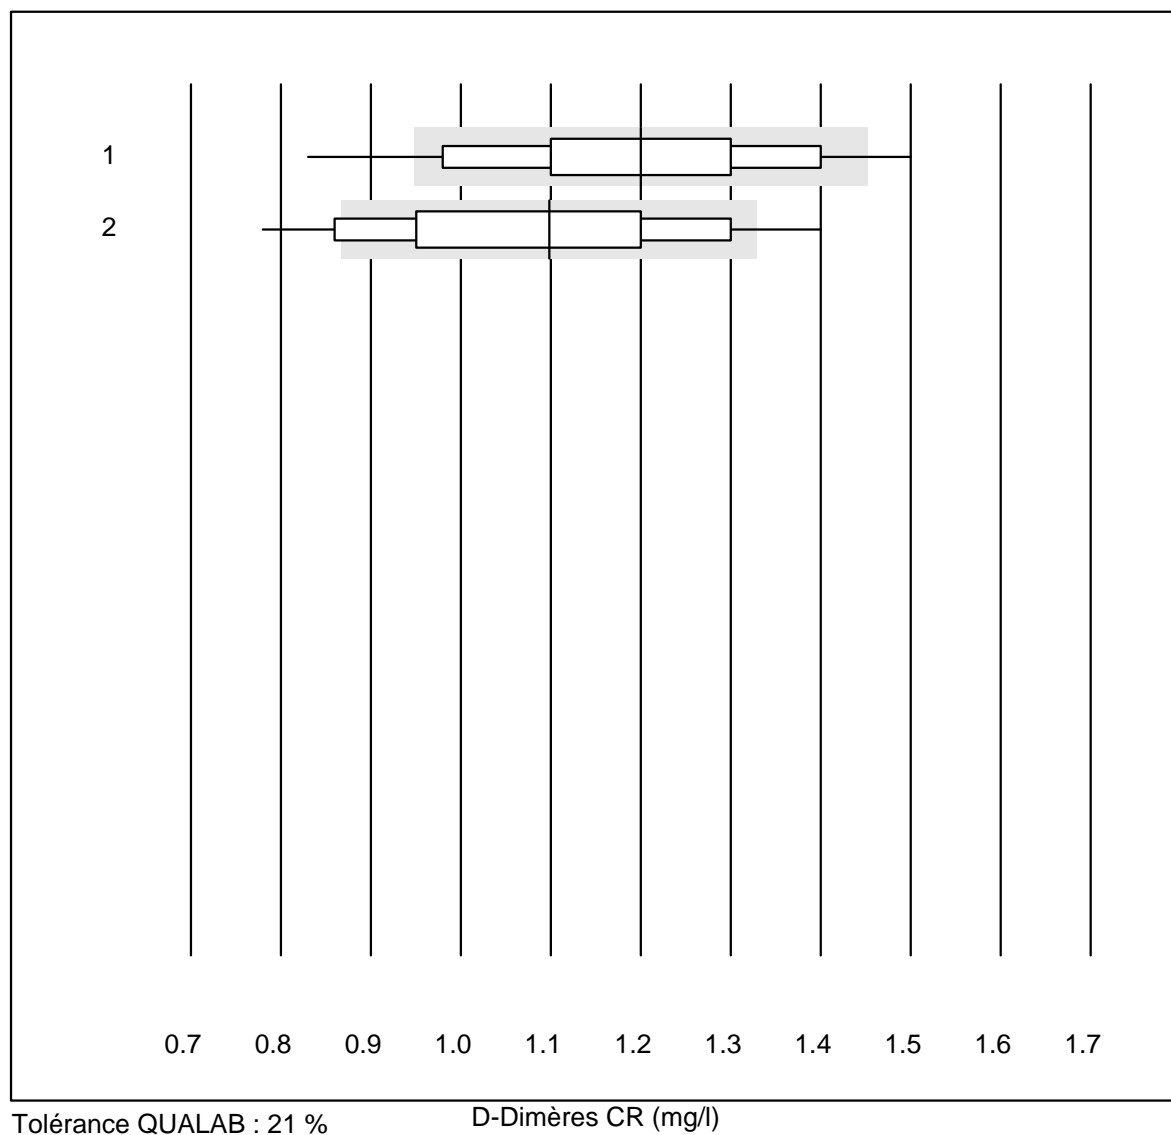

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas h 232	938	65.3	13.2	21.5	1.20	14.2	e
2	Cardiac Reader	35	65.7	14.3	20.0	1.10	15.6	e*

CKMB - K8

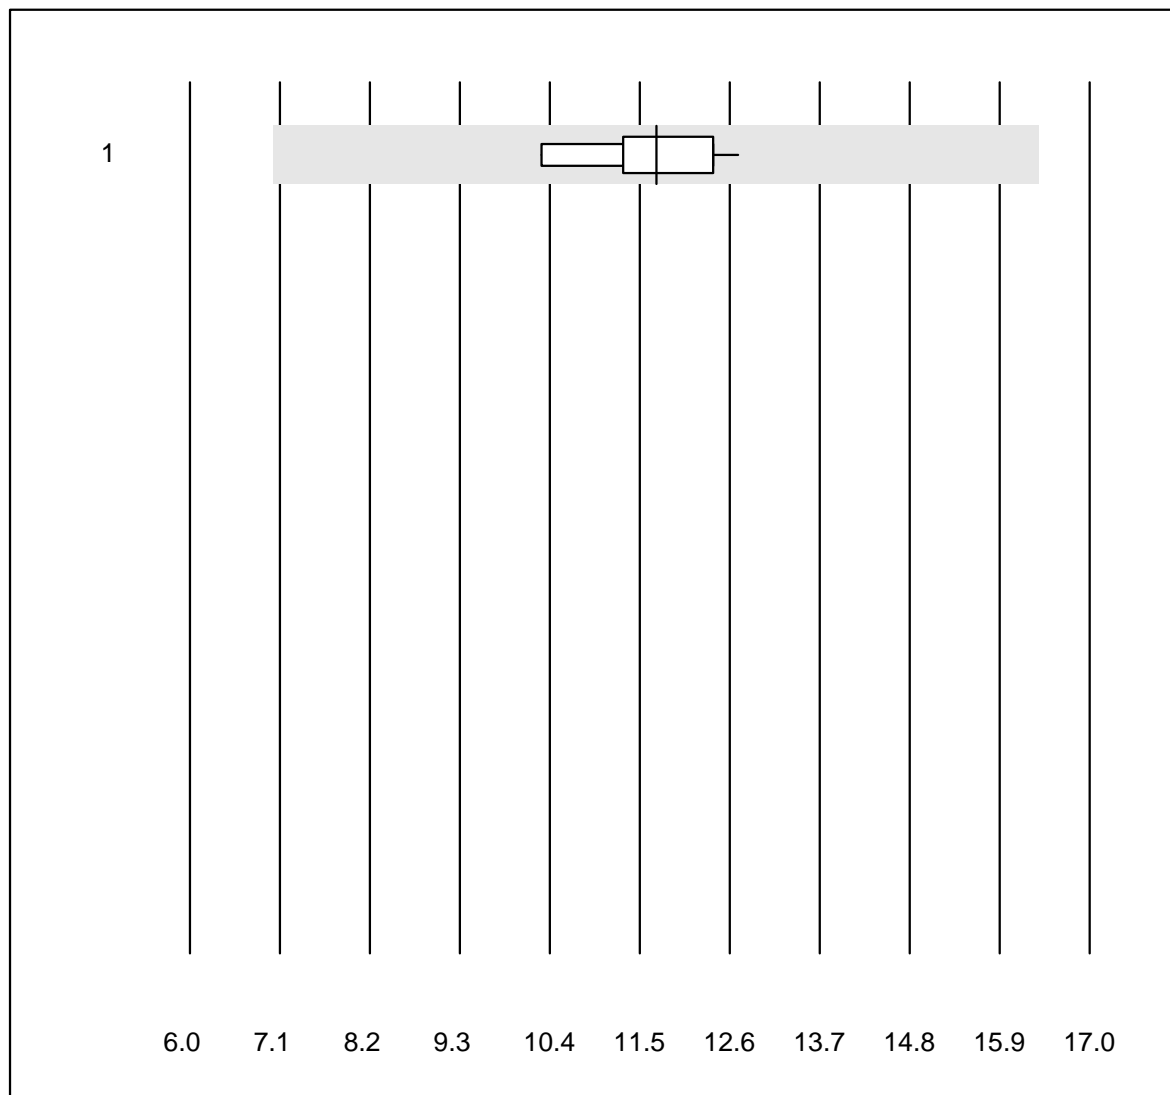


Tolérance QUALAB : 40 %

CKMB - K8 (µg/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas h 232	10	100.0	0.0	0.0	11.7	6.7	e

proBNP CR

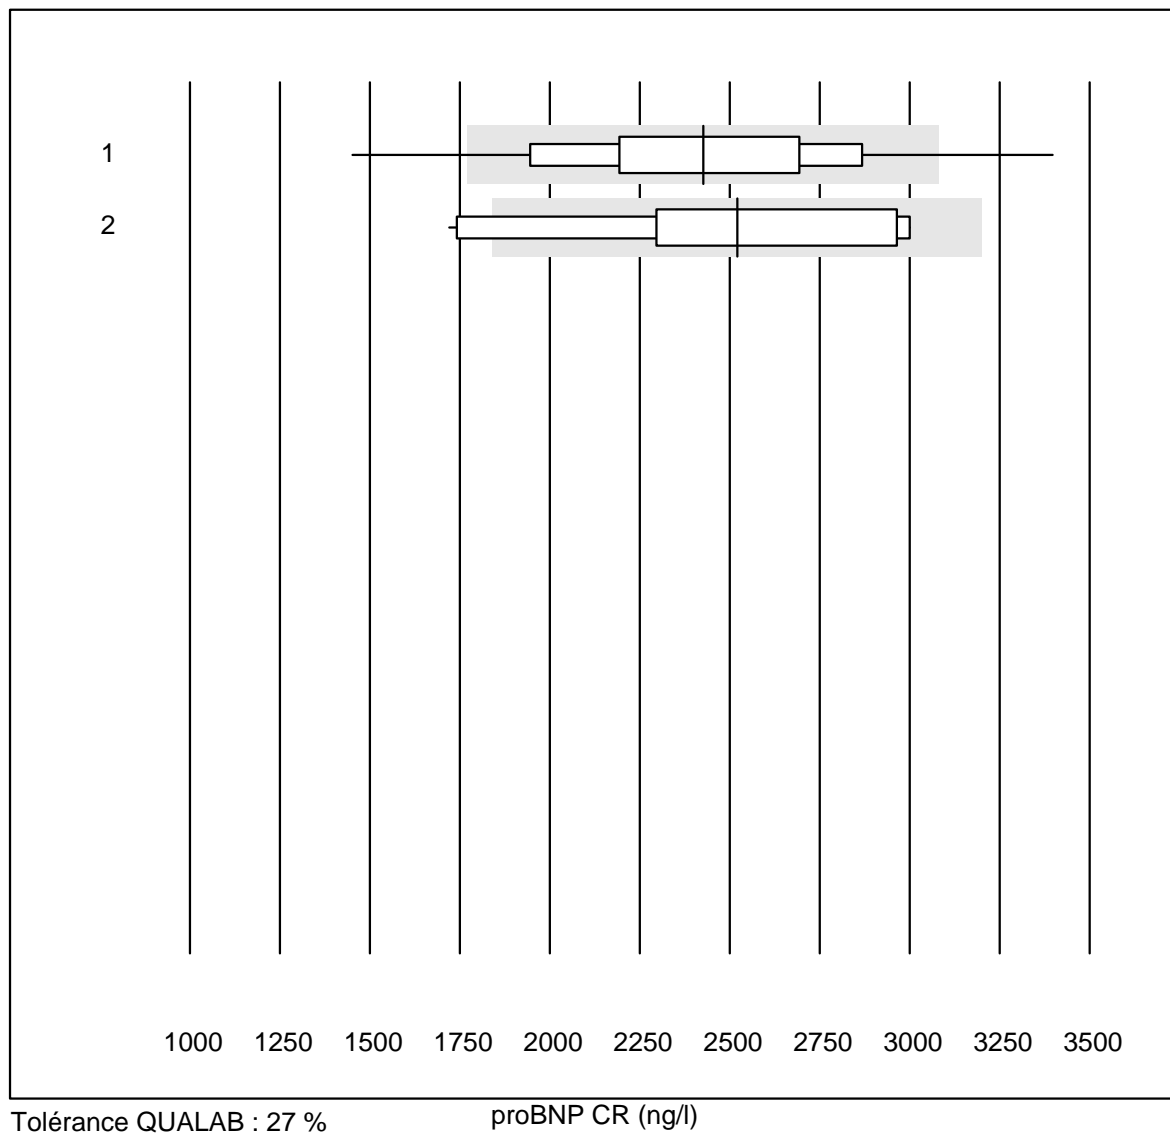

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas h 232	561	82.0	3.9	14.1	2427	14.2	e
2	Cardiac Reader	12	75.0	16.7	8.3	2521	18.8	e*

PCO2 CCA

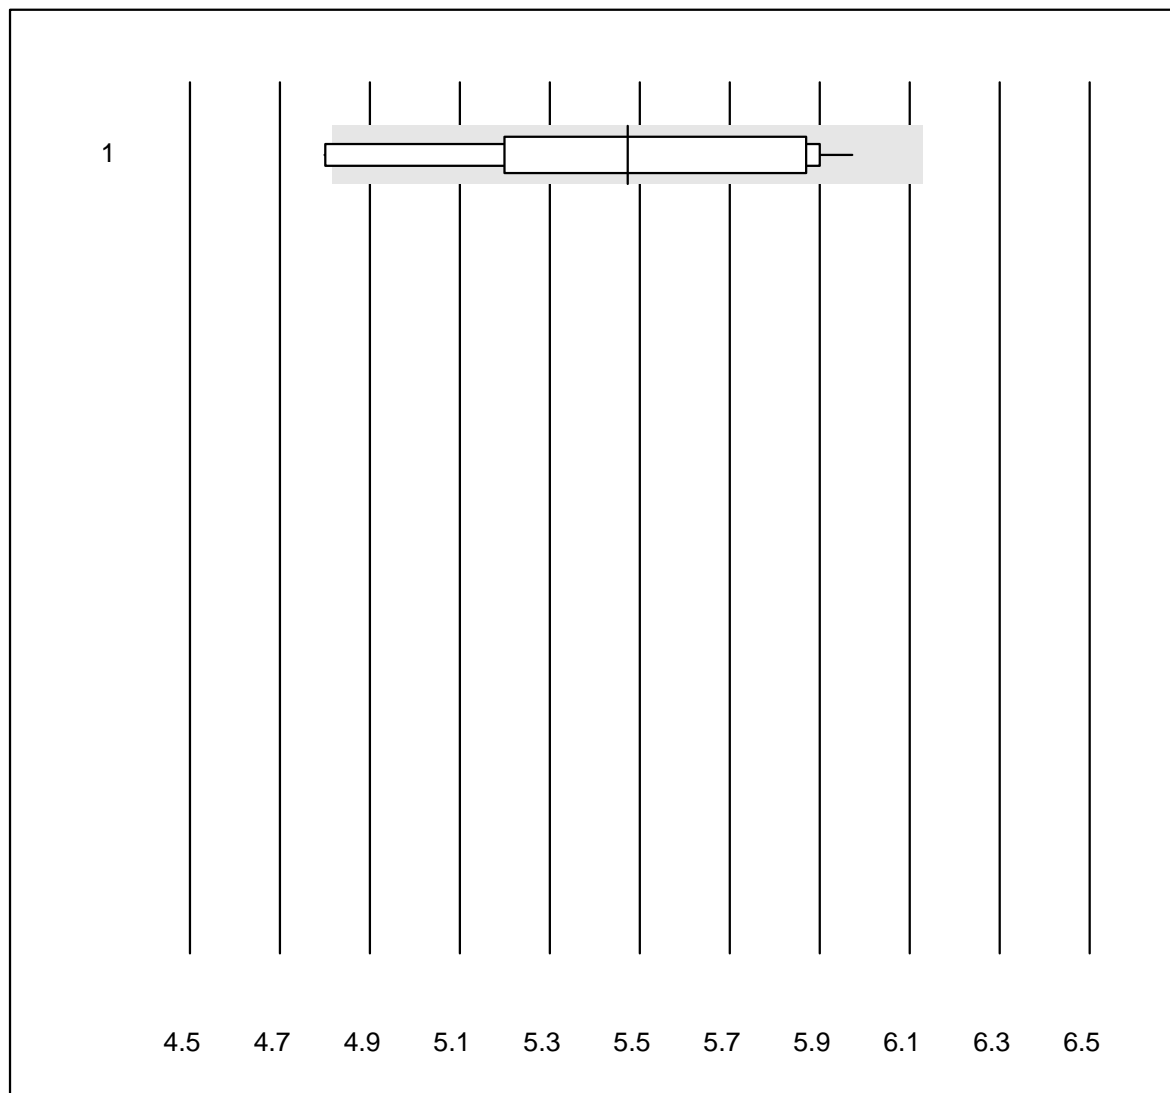


Tolérance QUALAB : 12 %

PCO2 CCA (kPa)

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 OPTI CCA	14	78.6	14.3	7.1	5.47	8.0	e*

PO2 CCA

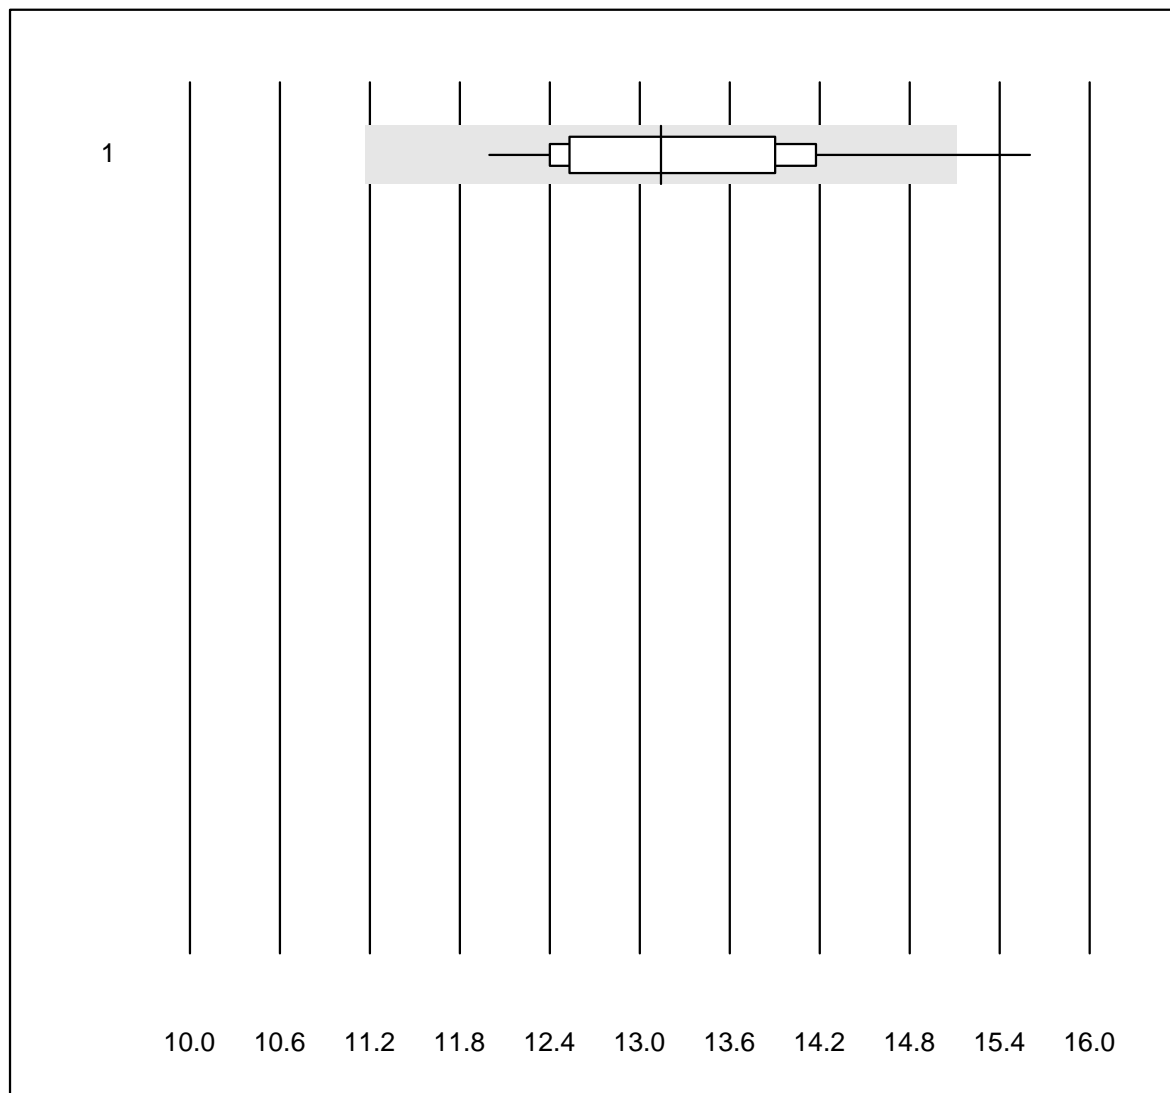


Tolérance QUALAB : 15 %

PO2 CCA (kPa)

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 OPTI CCA	14	71.5	7.1	21.4	13.14	8.1	e*

pH CCA

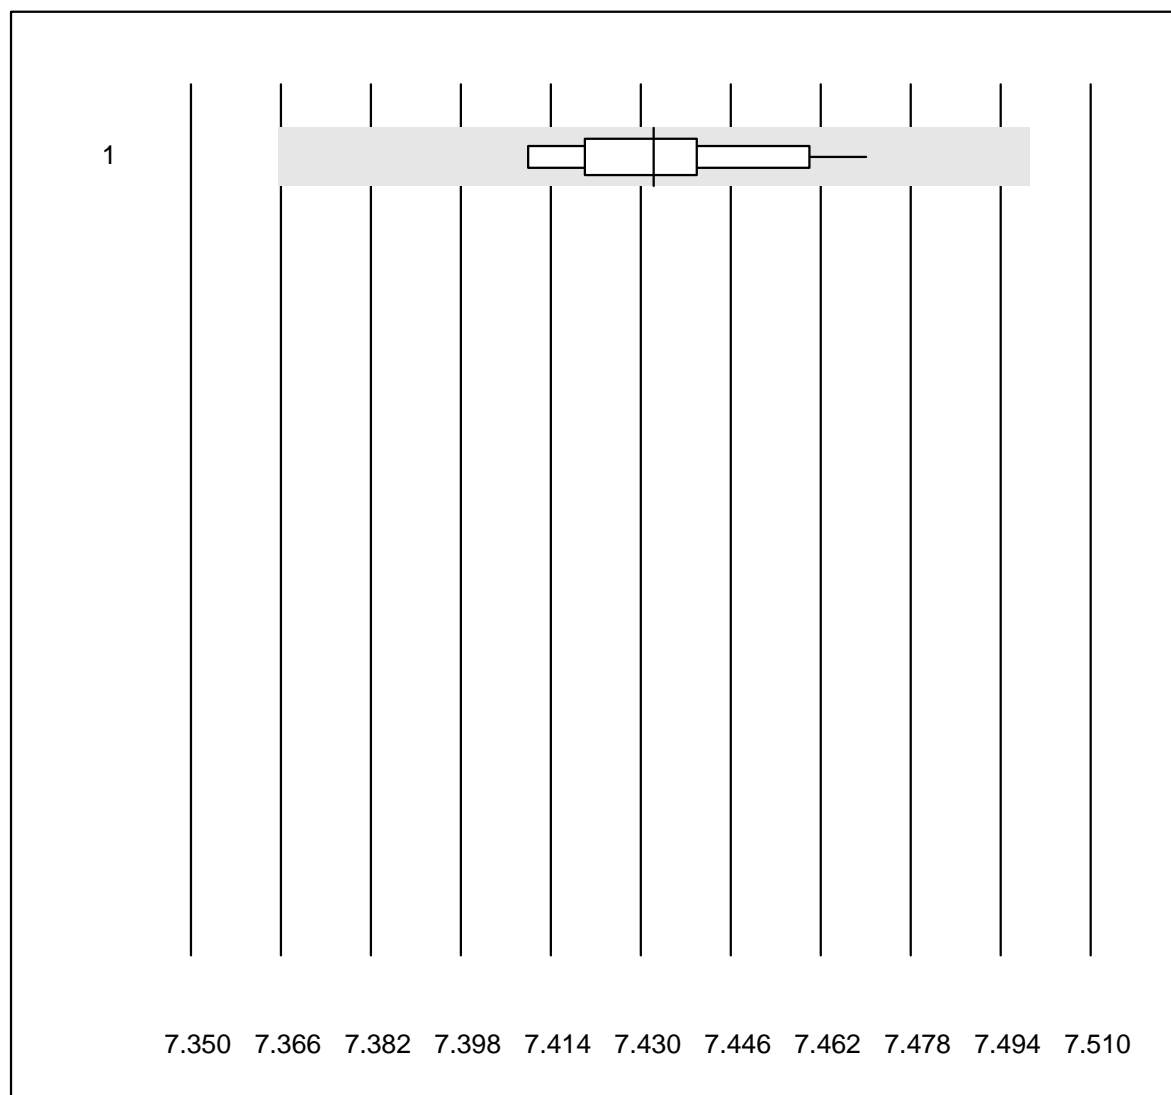


Tolérance QUALAB : 1 %

pH CCA ()

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 OPTI CCA	14	100.0	0.0	0.0	7.43	0.2	e

Potassium CCA

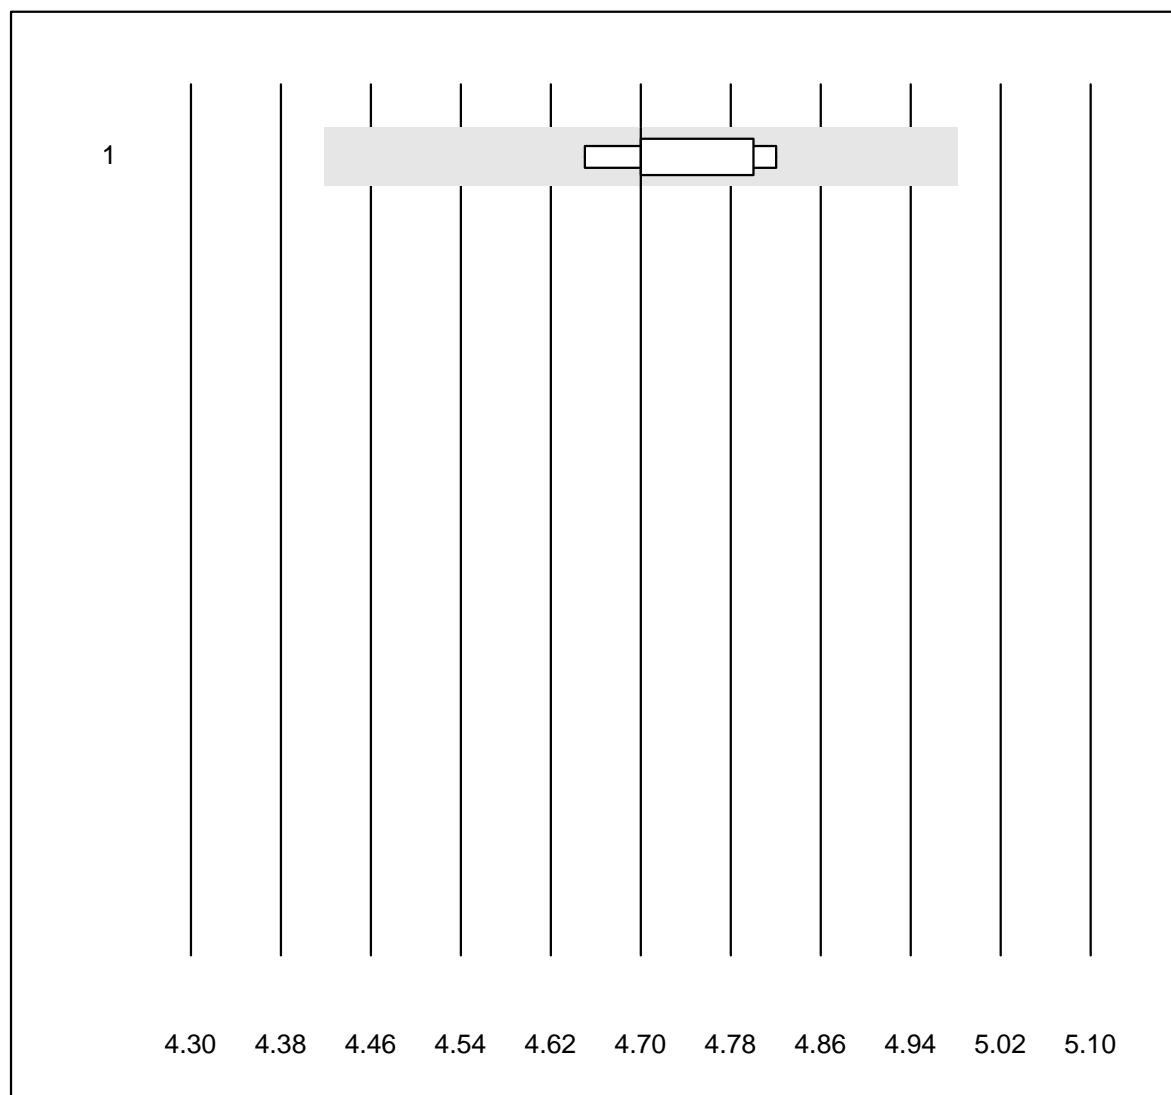


Tolérance QUALAB : 6 %

Potassium CCA (mmol/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 OPTI CCA	6	100.0	0.0	0.0	4.7	1.4	e

Sodium CCA

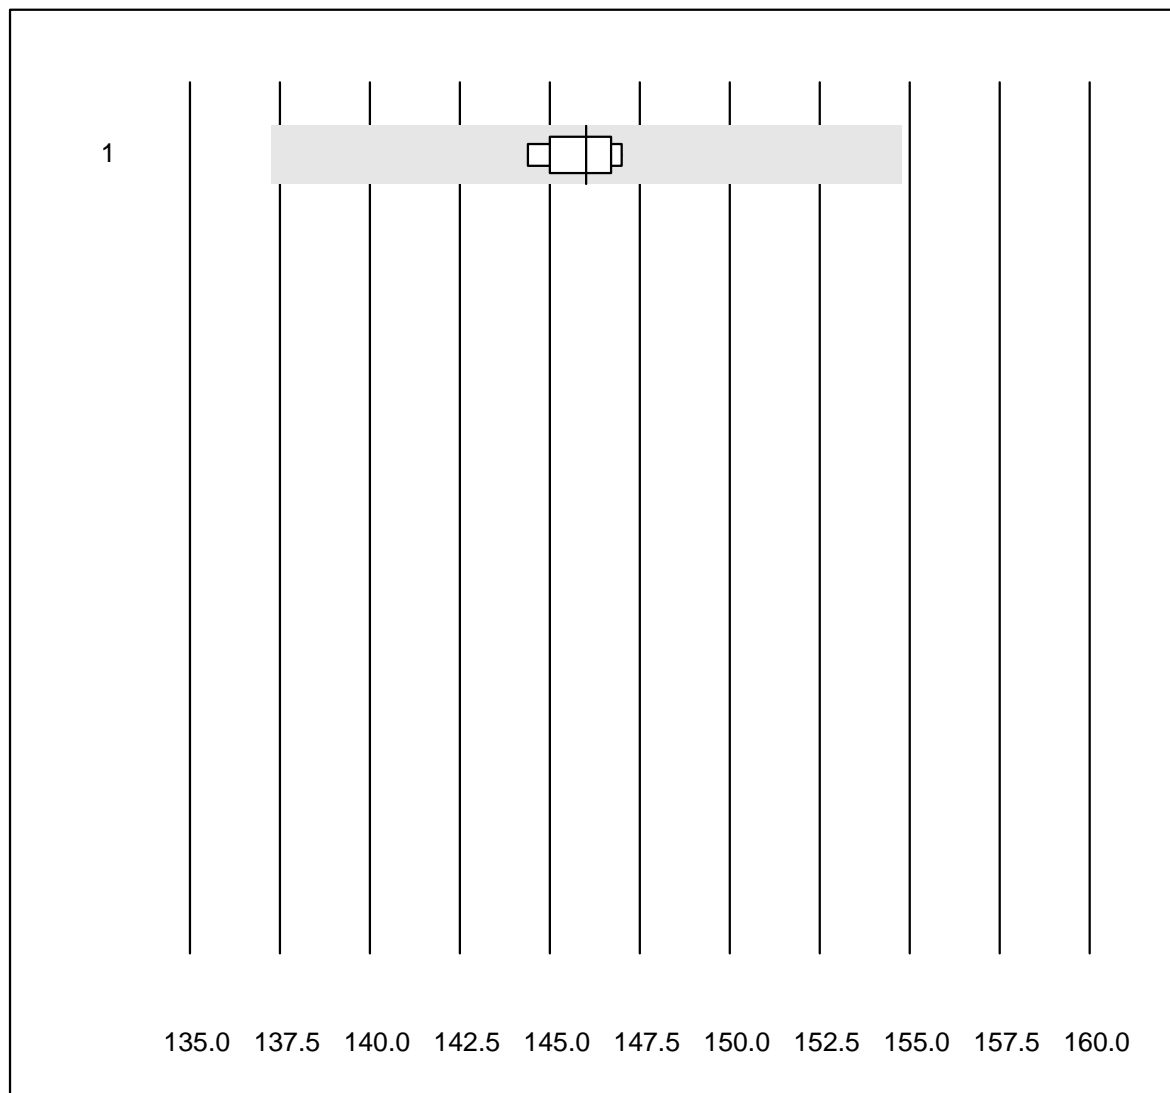


Tolérance QUALAB : 6 %

Sodium CCA (mmol/l)


No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 OPTI CCA	5	100.0	0.0	0.0	146.0	0.8	e

Ferritine

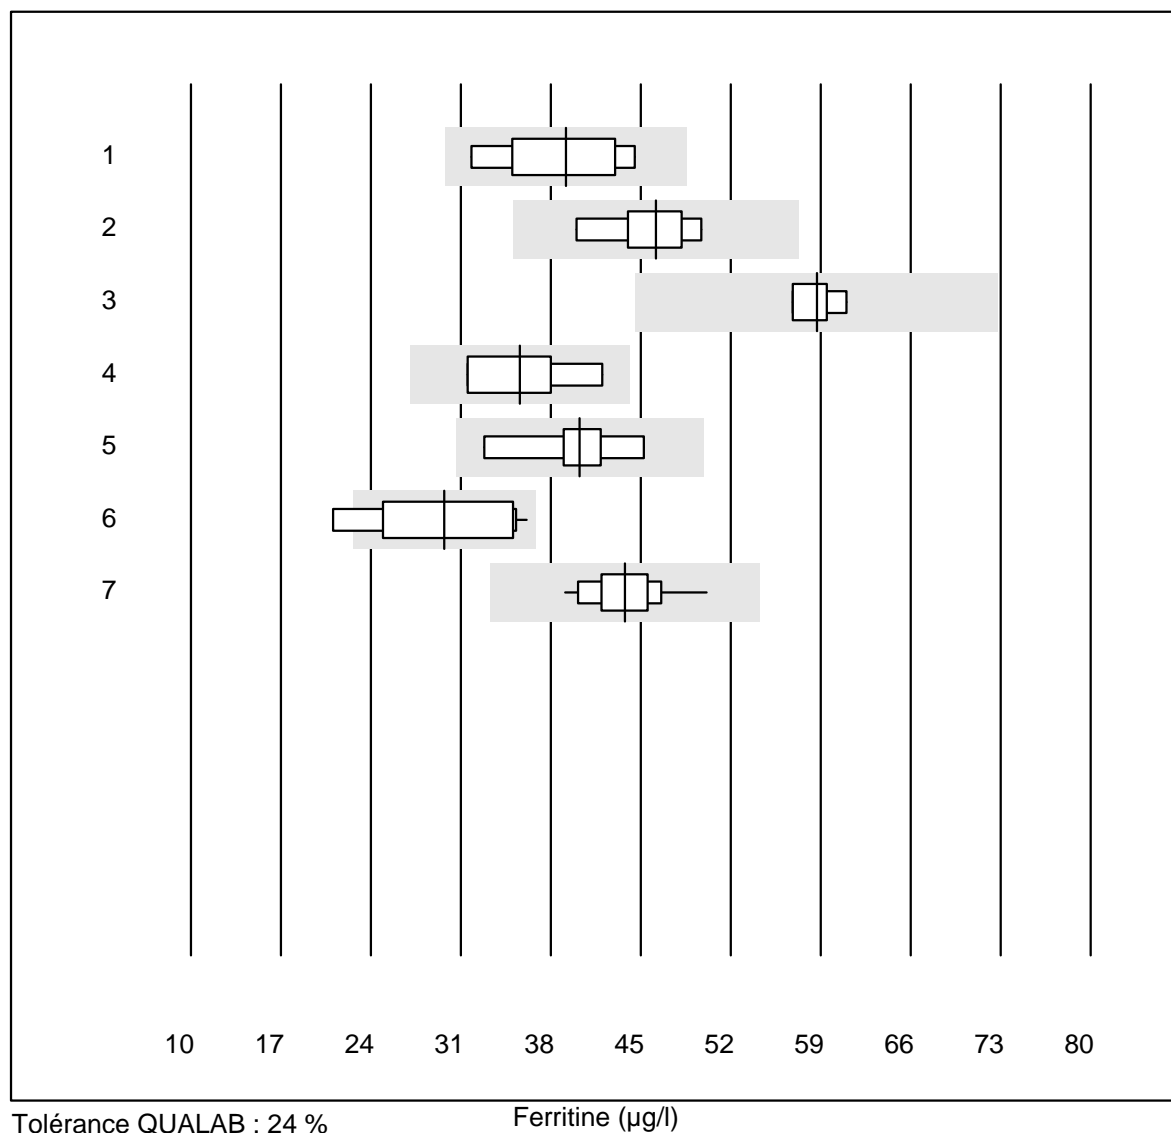

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Beckman	5	100.0	0.0	0.0	39.20	13.8	e*
2 Cobas E / Elecsys	9	100.0	0.0	0.0	46.20	7.0	e
3 Architect	4	100.0	0.0	0.0	58.69	3.1	e
4 Mira/DiaSys	4	100.0	0.0	0.0	35.60	13.2	e*
5 Mini Vidas	6	100.0	0.0	0.0	40.24	10.3	e*
6 AFIAS	11	81.8	9.1	9.1	29.70	18.2	e*
7 Eurolyser	19	84.2	0.0	15.8	43.74	6.3	e

Vitamine B12

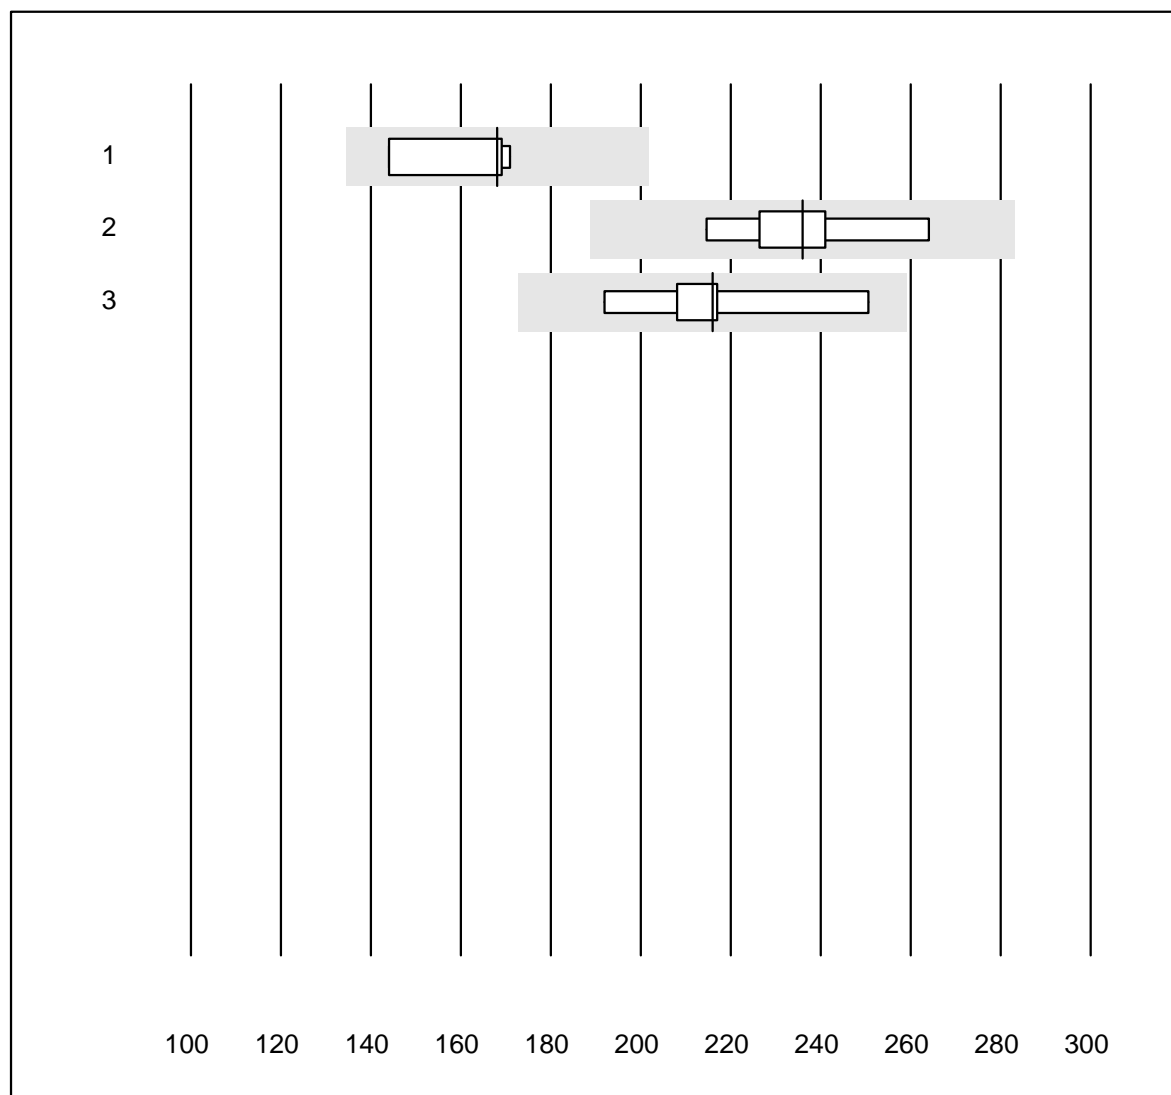


Tolérance QUALAB : 20 %

Vitamine B12 (pmol/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	168.00	7.7	e*
2 Cobas E / Elecsys	7	100.0	0.0	0.0	236.00	6.5	e*
3 Architect	5	100.0	0.0	0.0	216.00	9.9	e*

Folate

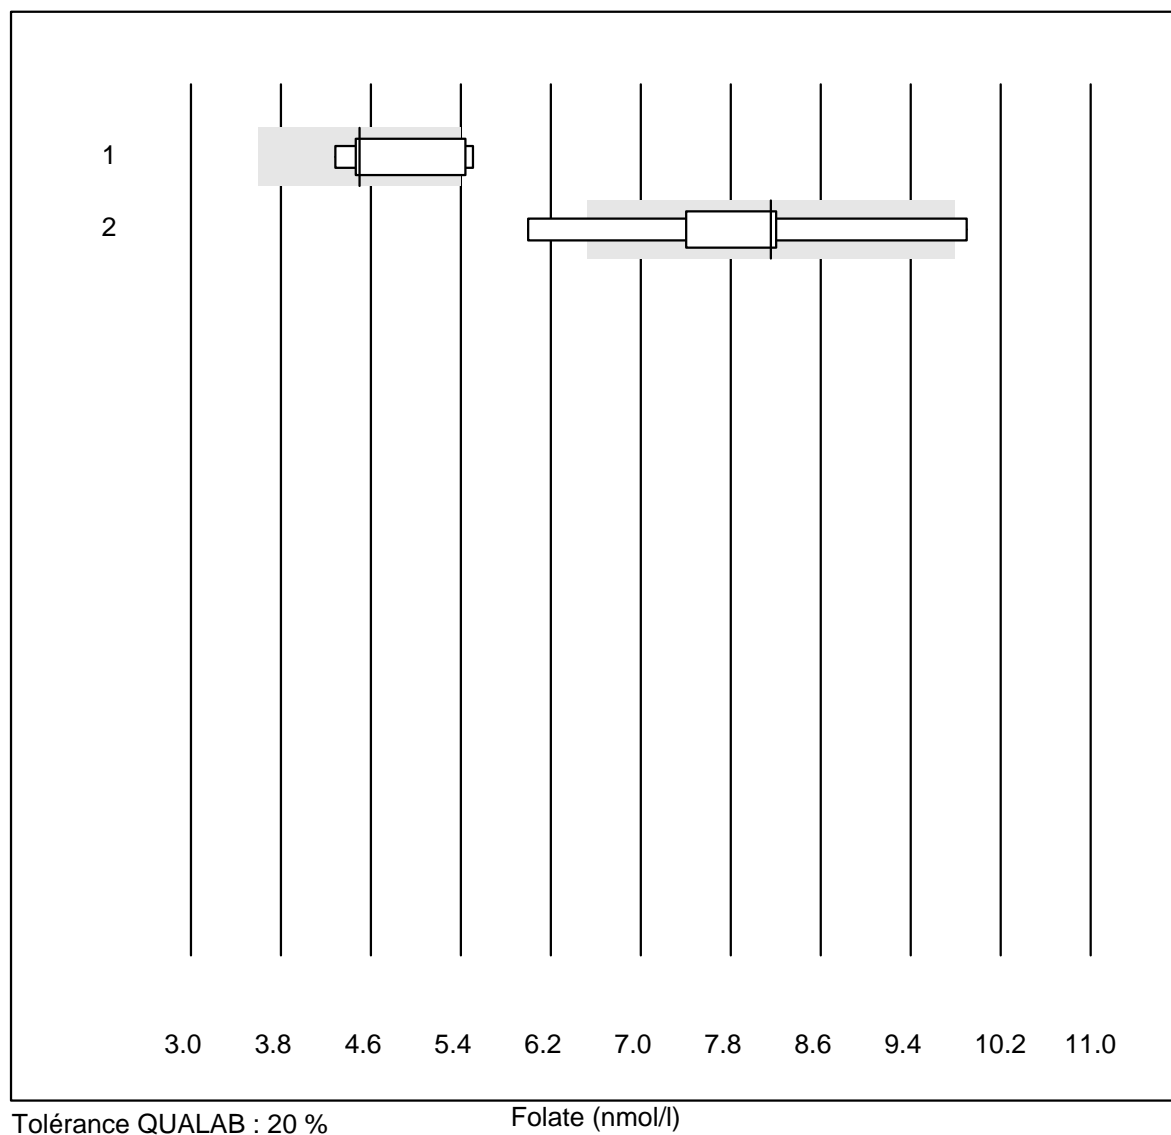

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	7	71.4	28.6	0.0	4.50	10.8	e*
2 Architect	5	60.0	40.0	0.0	8.16	17.8	e*

BNP

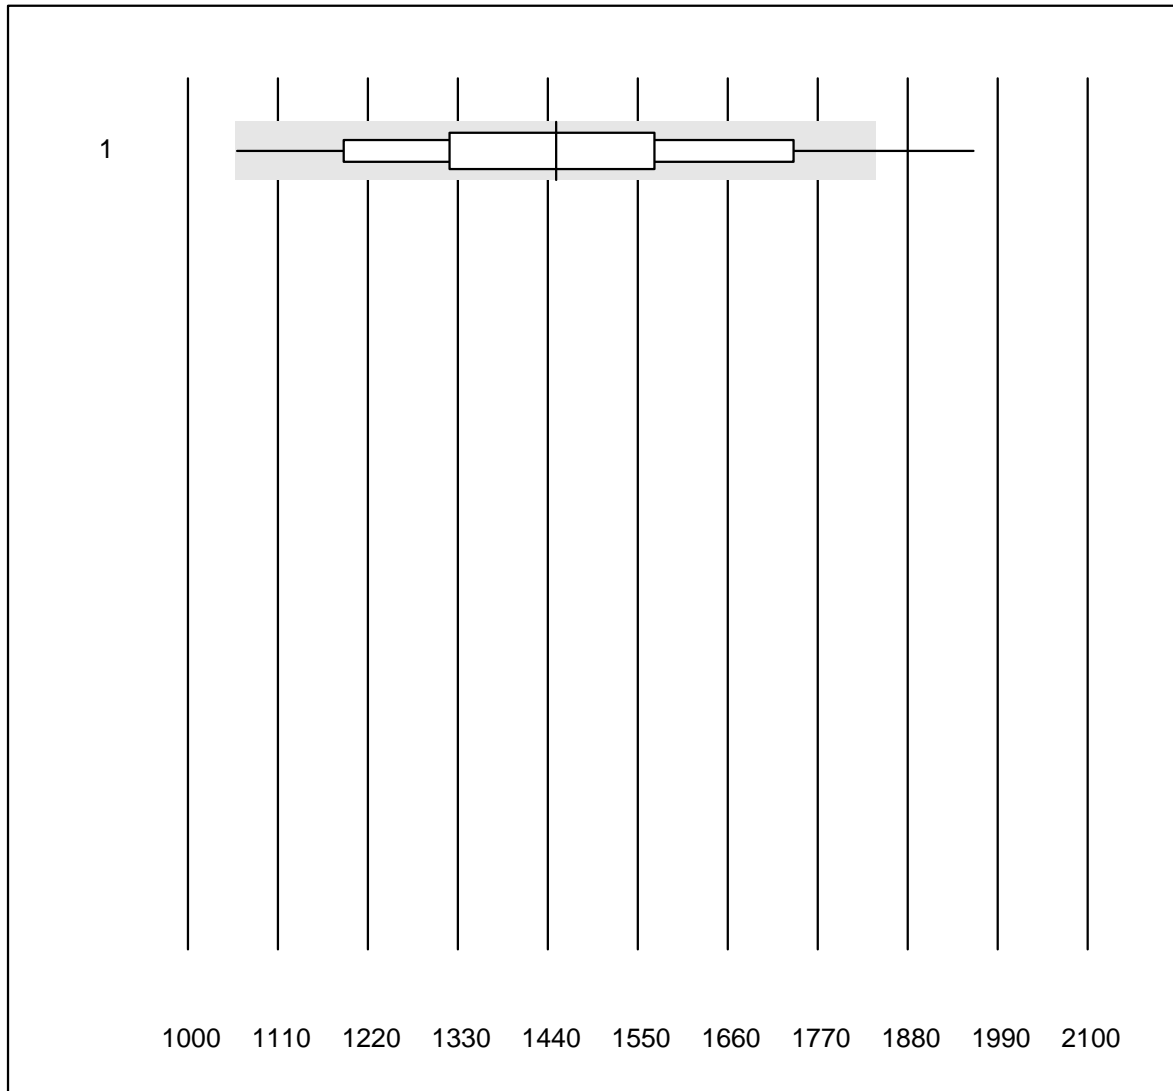


Tolérance QUALAB : 27 %

BNP (ng/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Triage	43	83.7	9.3	7.0	1450.0	14.7	e

NT-Pro-BNP

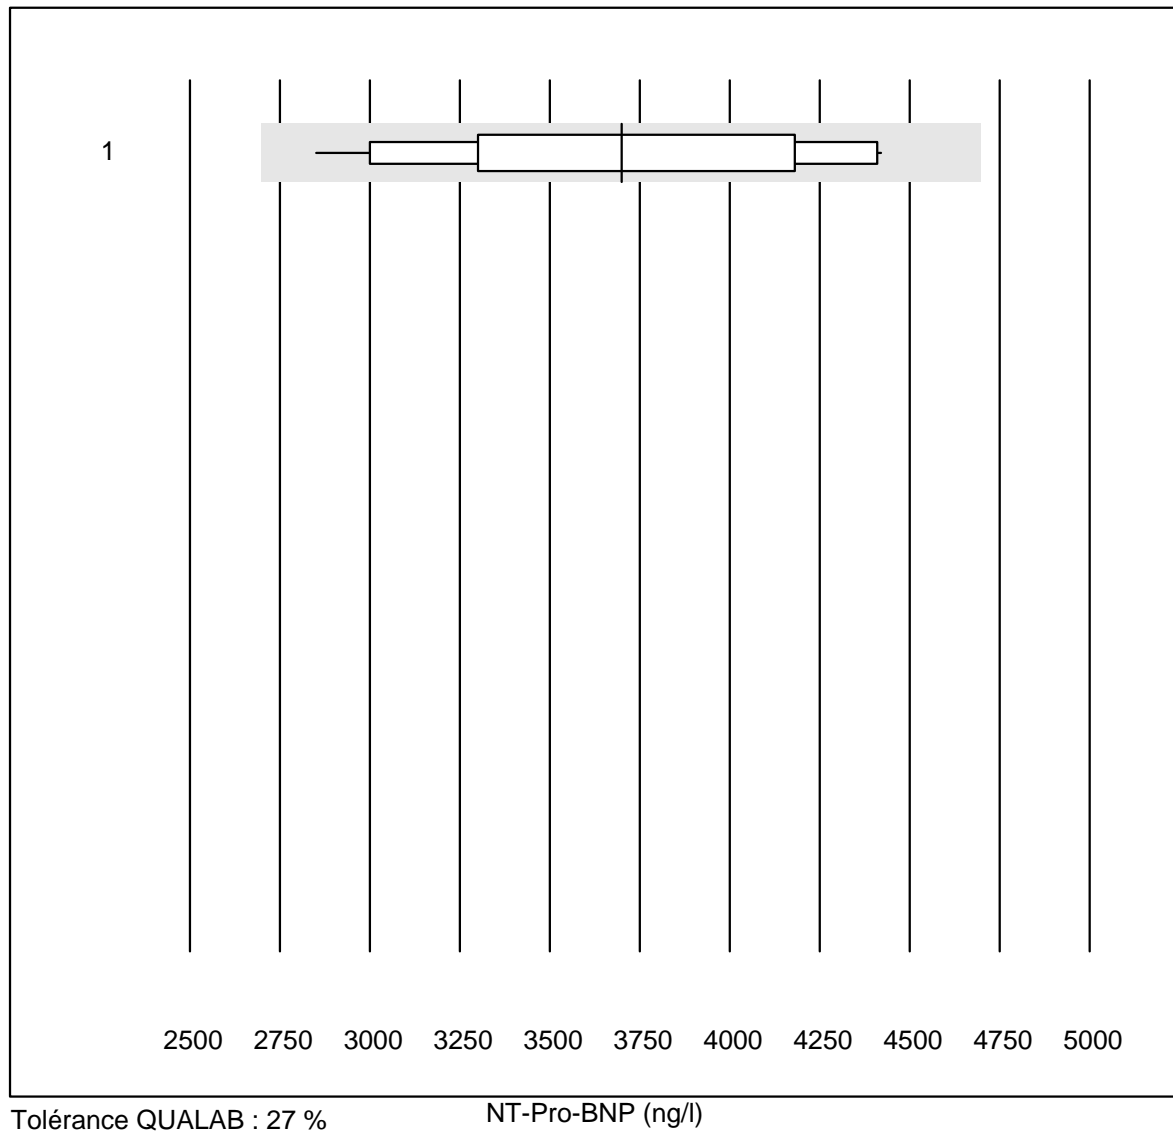


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Triage	13	84.6	0.0	15.4	3699	14.2	e*

G10 Quick WB

Quick / INR WB

Hôpital universitaire de Zurich

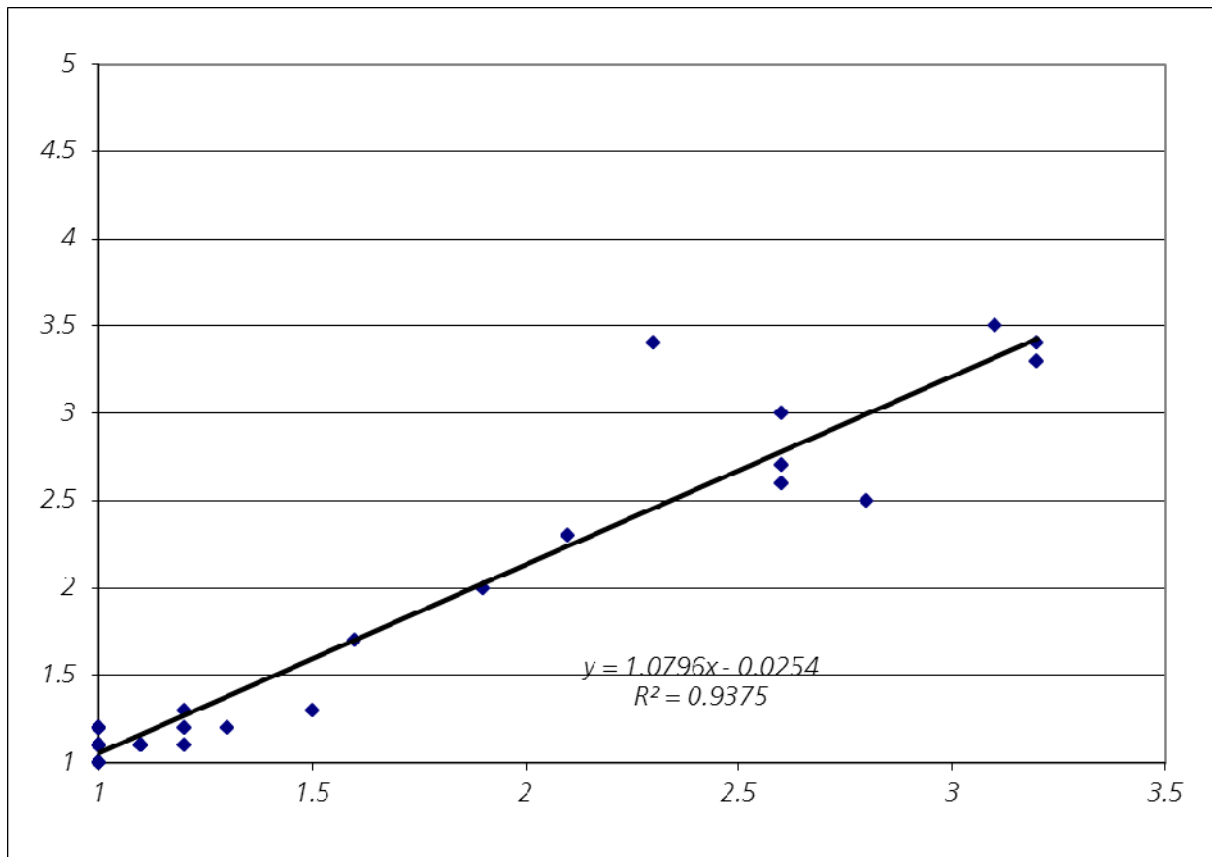


Participants INRatio

Pour l'essai interlaboratoire G10, les appareils des participants sont comparés avec la détermination de l'INR à l'Hôpital universitaire de Zurich.

Nr.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé
1	INRatio	42	92.86	4.76	2.38

Bilirubin totale Neo

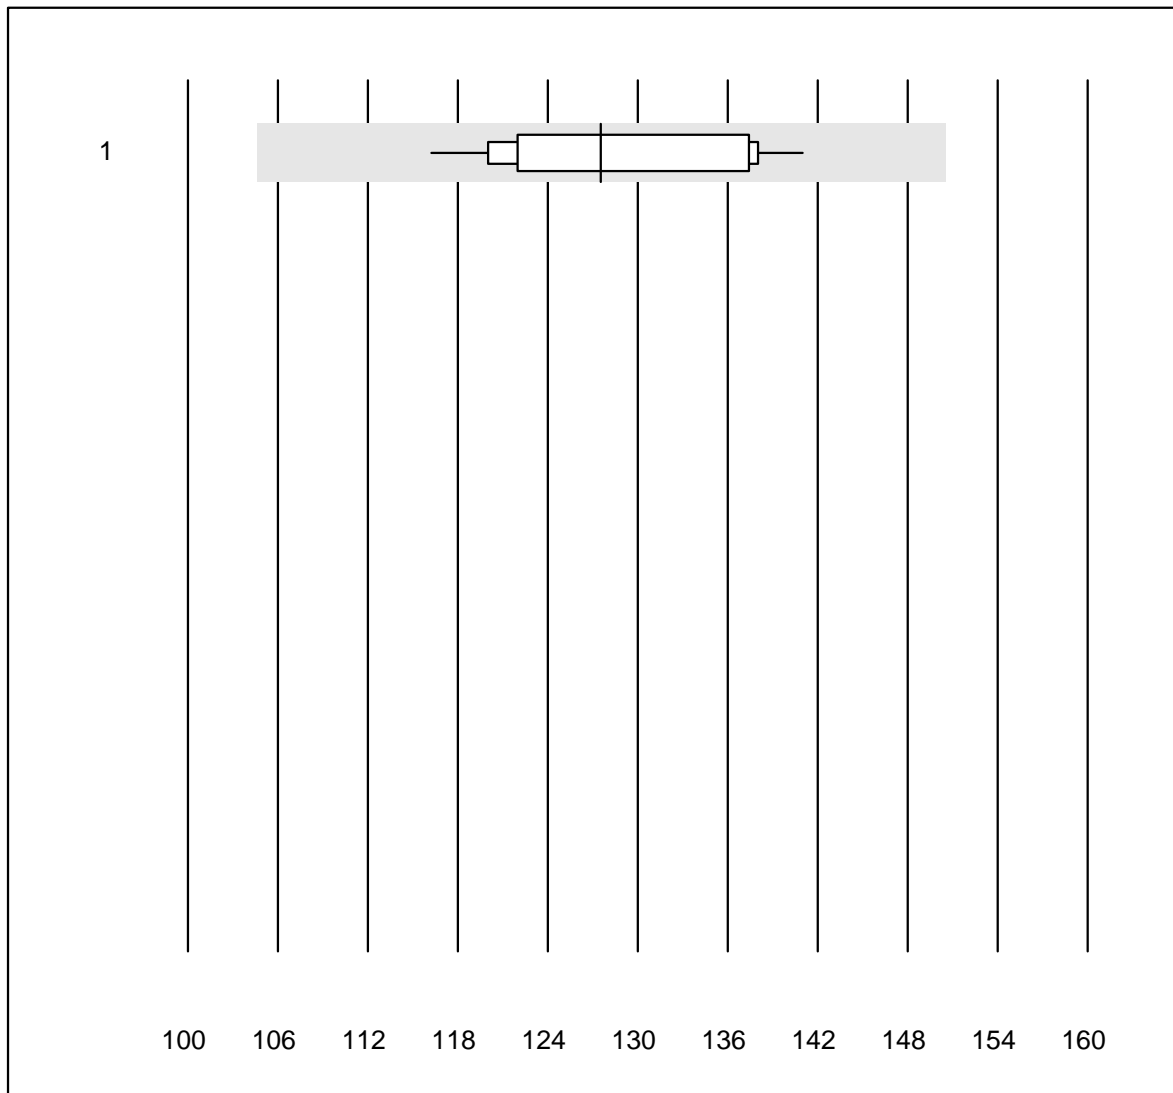


Tolérance QUALAB : 18 %

Bilirubin totale Neo ($\mu\text{mol/l}$)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	15	93.3	0.0	6.7	128	6.4	e

Bilirubin directe

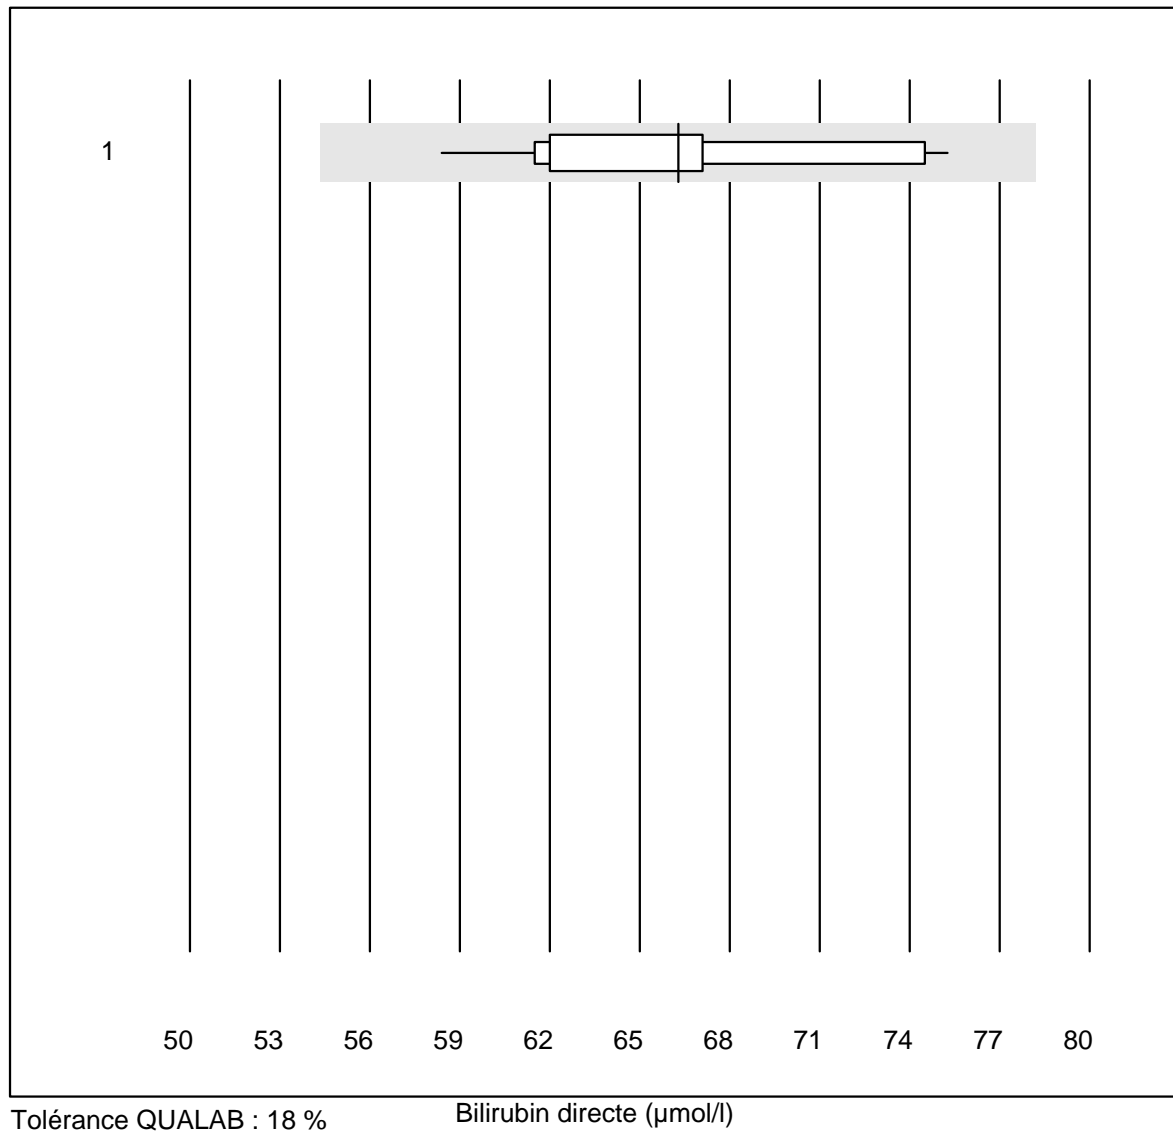

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	13	84.6	0.0	15.4	66	7.6	e

Bilirubin néonatale

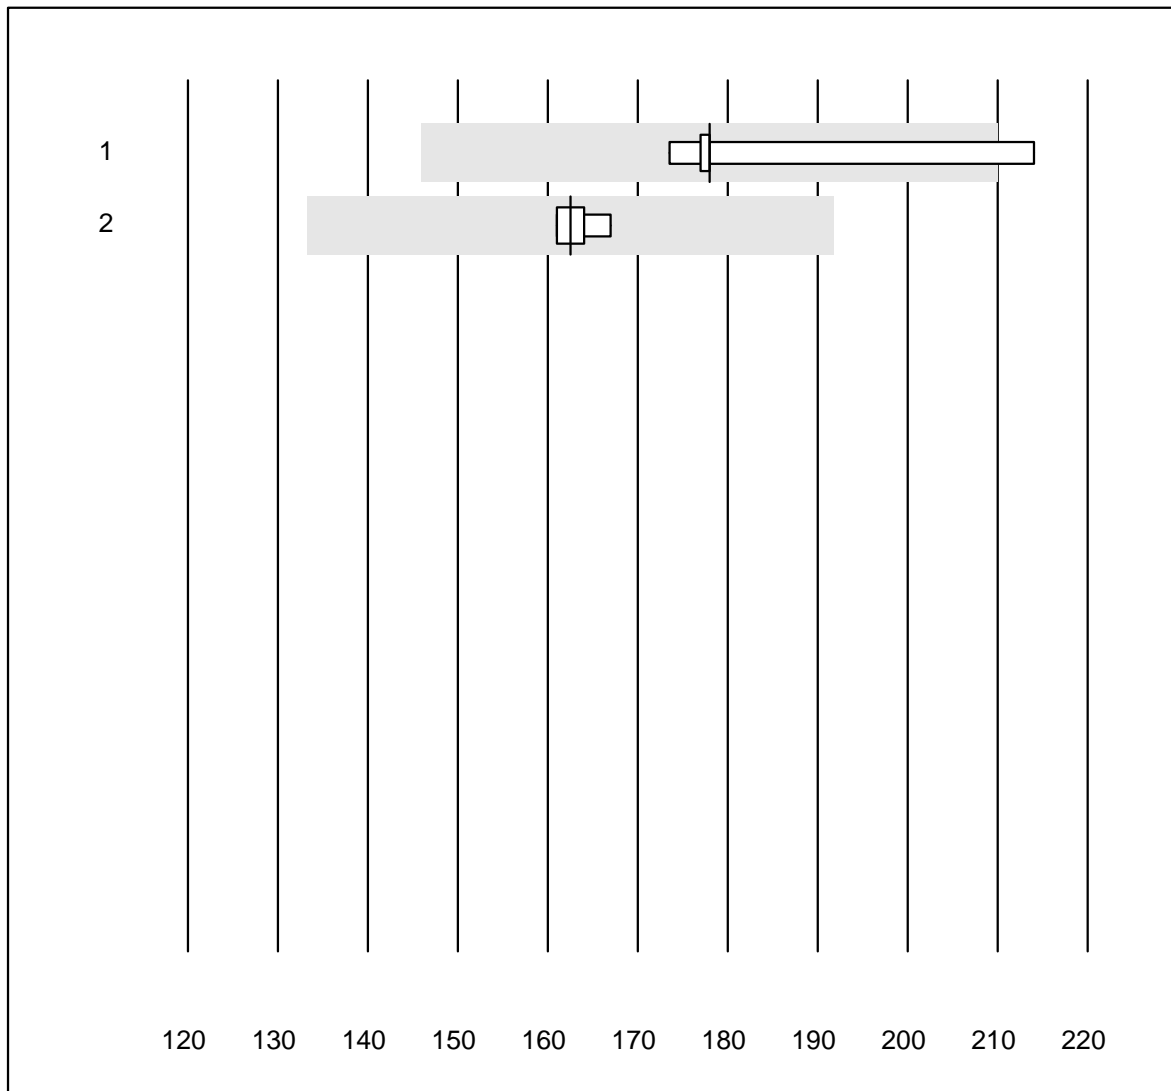


Tolérance QUALAB : 18 %

Bilirubin néonatale (µmol/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	6	83.3	16.7	0.0	178	8.3	e*
2	ABL700/800	4	100.0	0.0	0.0	163	1.8	e

CK-MB

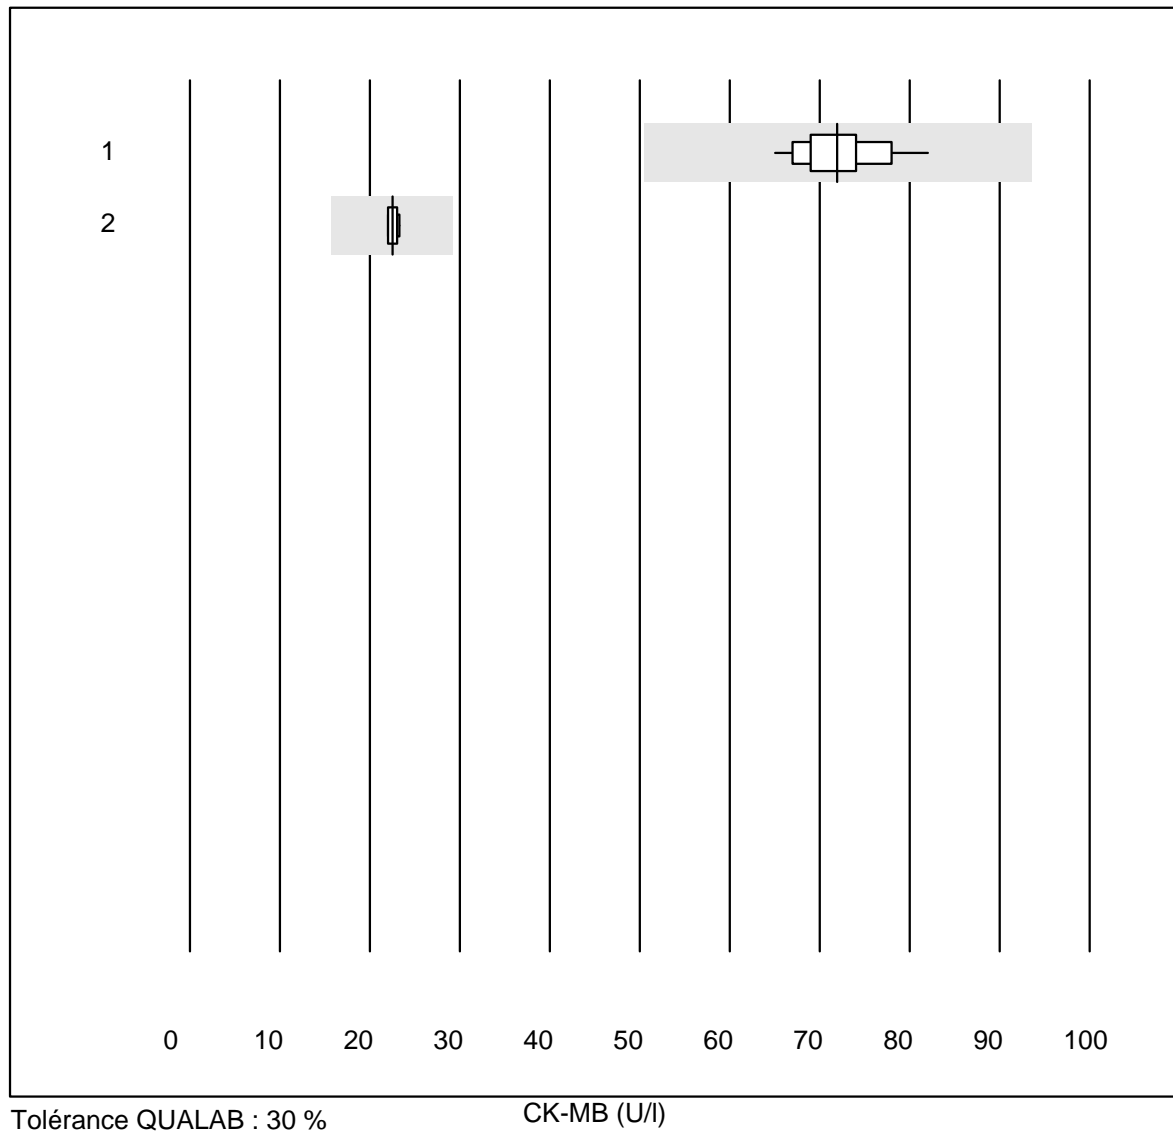


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Fuji Dri-Chem	40	95.0	0.0	5.0	72.0	5.7	e
2 Cobas/Roche	4	100.0	0.0	0.0	22.5	3.0	e

PSA

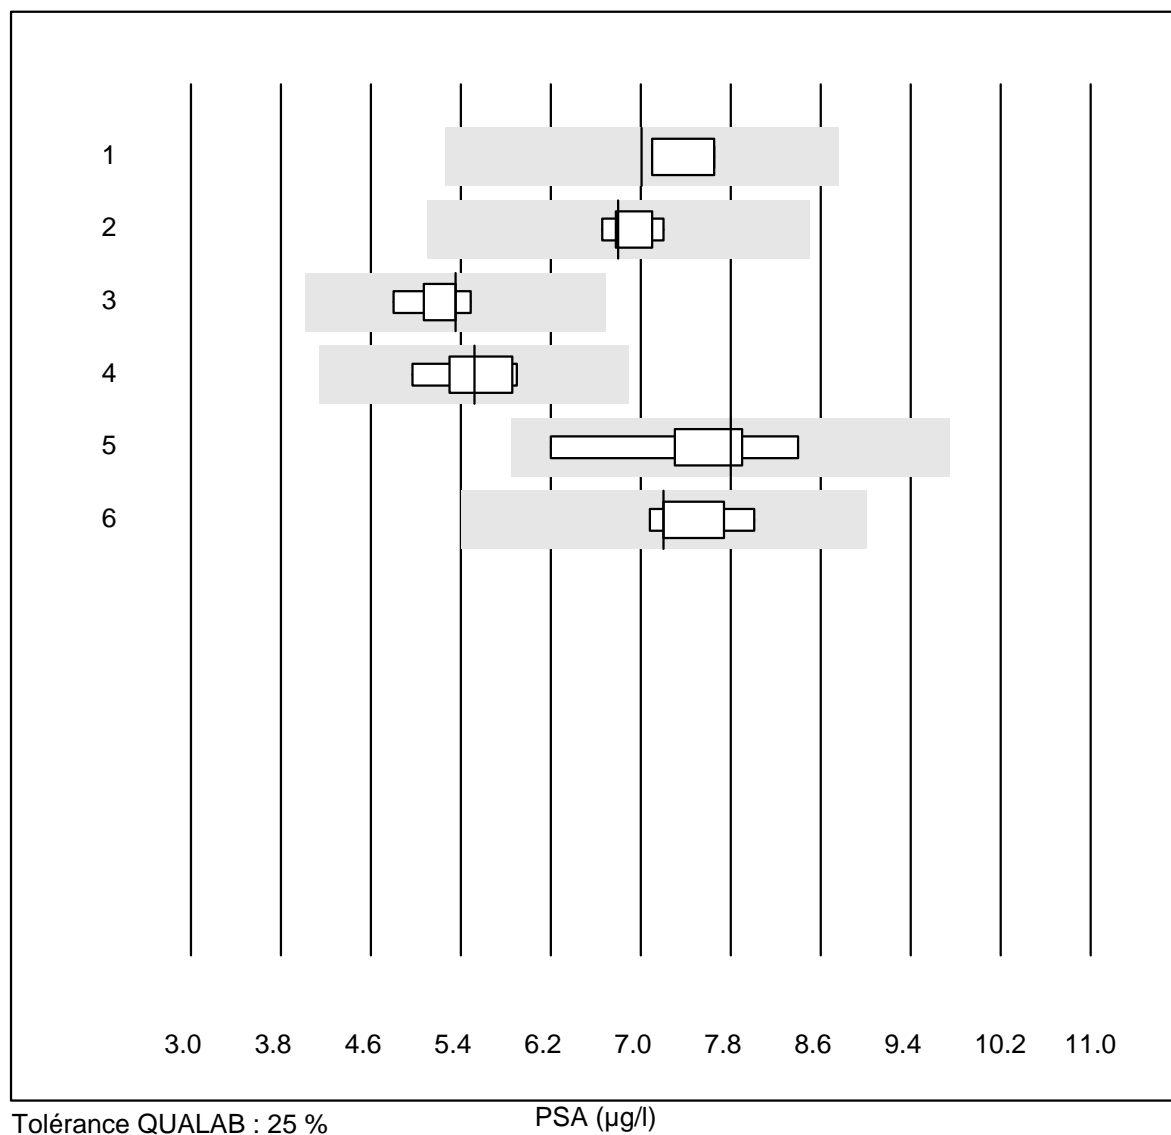


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Autres méthodes	4	75.0	0.0	25.0	7.01	3.9	a
2	Cobas E / Elecsys	9	100.0	0.0	0.0	6.80	3.0	e
3	ADVIA Centaur XP/CP	5	100.0	0.0	0.0	5.35	5.1	a
4	Architect	6	100.0	0.0	0.0	5.52	6.6	a
5	Qualigen	7	100.0	0.0	0.0	7.80	9.3	e*
6	AFIAS	8	100.0	0.0	0.0	7.20	4.4	a

PSA frei

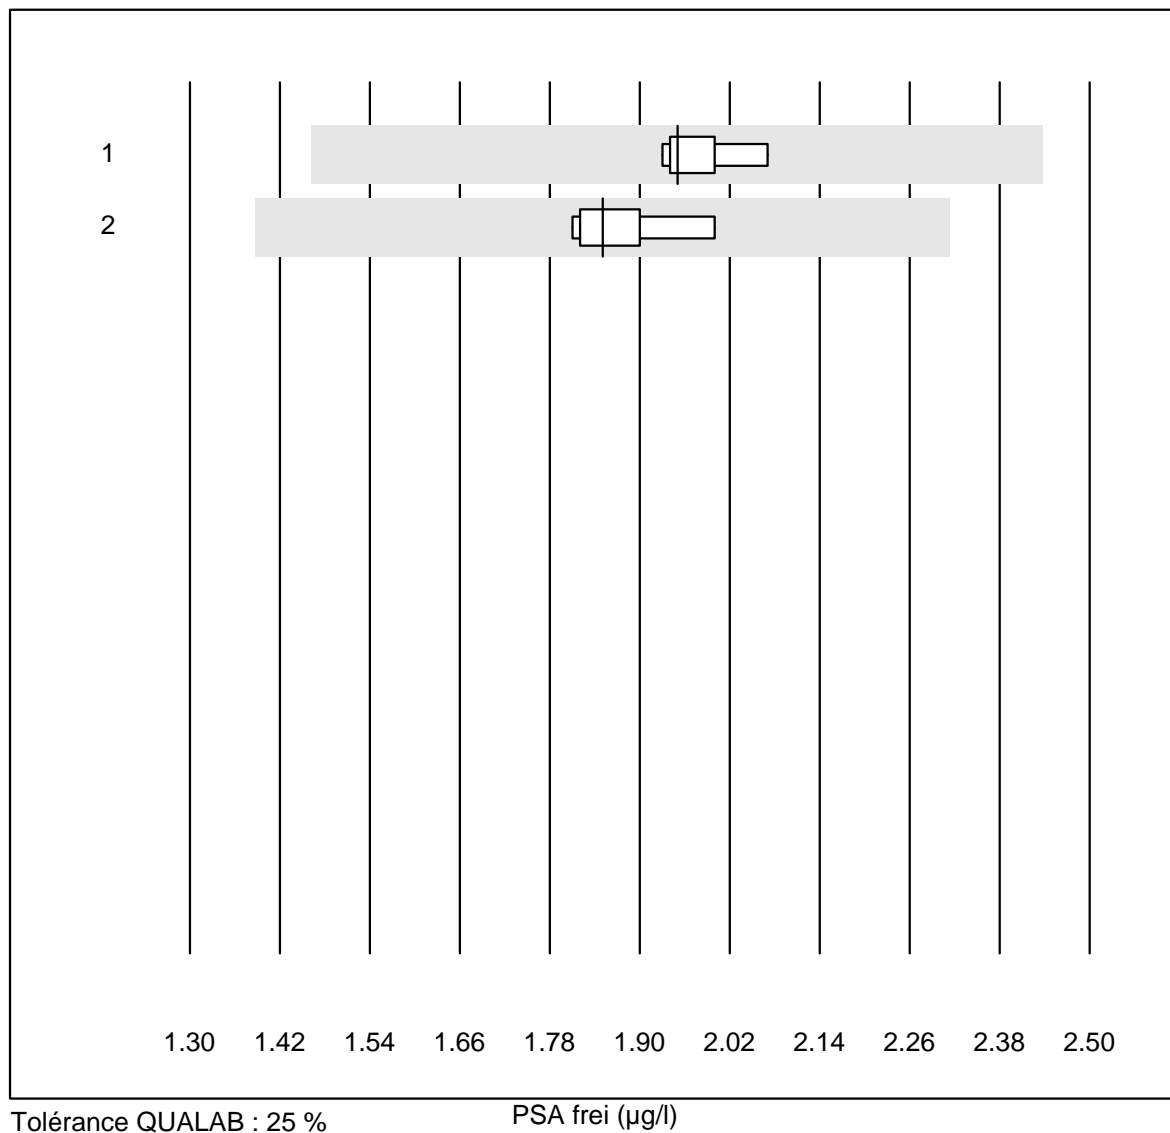

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	5	100.0	0.0	0.0	1.95	2.8	a
2	Architect	5	100.0	0.0	0.0	1.85	4.1	e

CEA

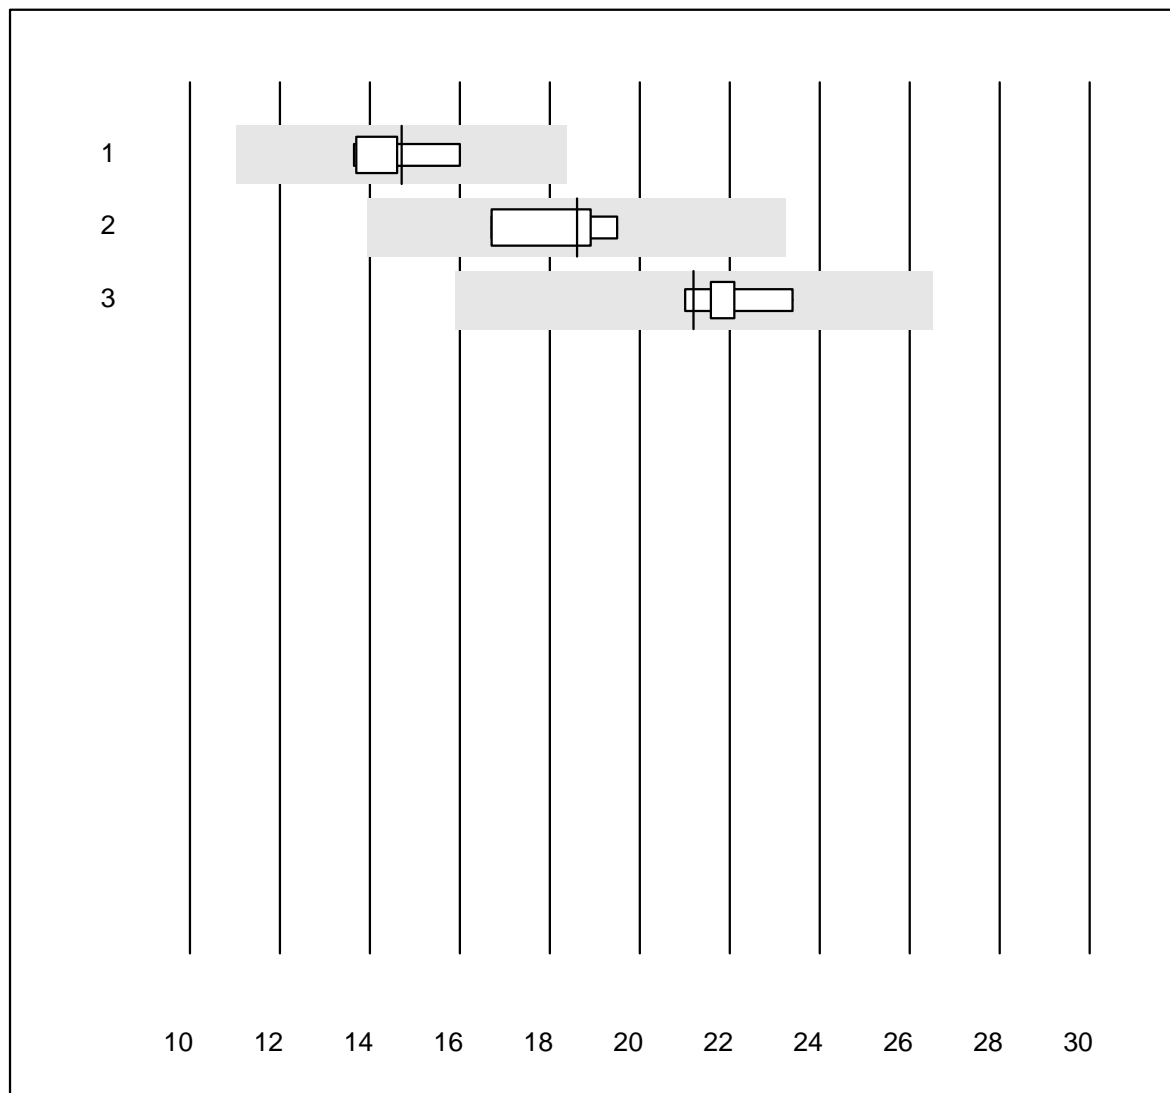


Tolérance QUALAB : 25 %

CEA (µg/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	6	100.0	0.0	0.0	14.7	5.9	a
2	ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	18.6	6.6	e*
3	Architect	5	100.0	0.0	0.0	21.2	4.1	a

CA 125

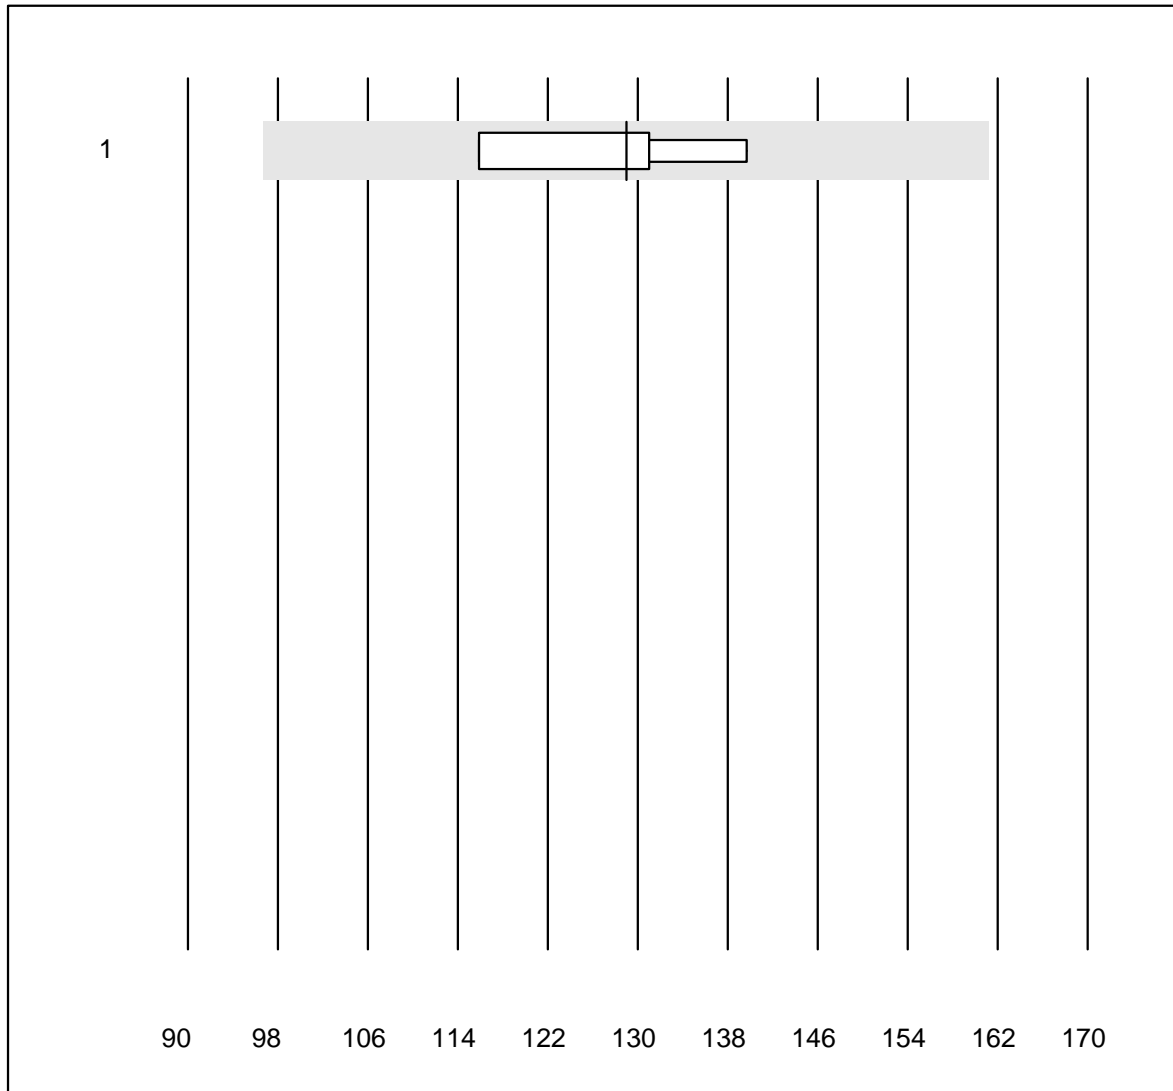


Tolérance QUALAB : 25 %

CA 125 (kIU/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Architect	4	100.0	0.0	0.0	129.0	7.9	a

CA 15-3

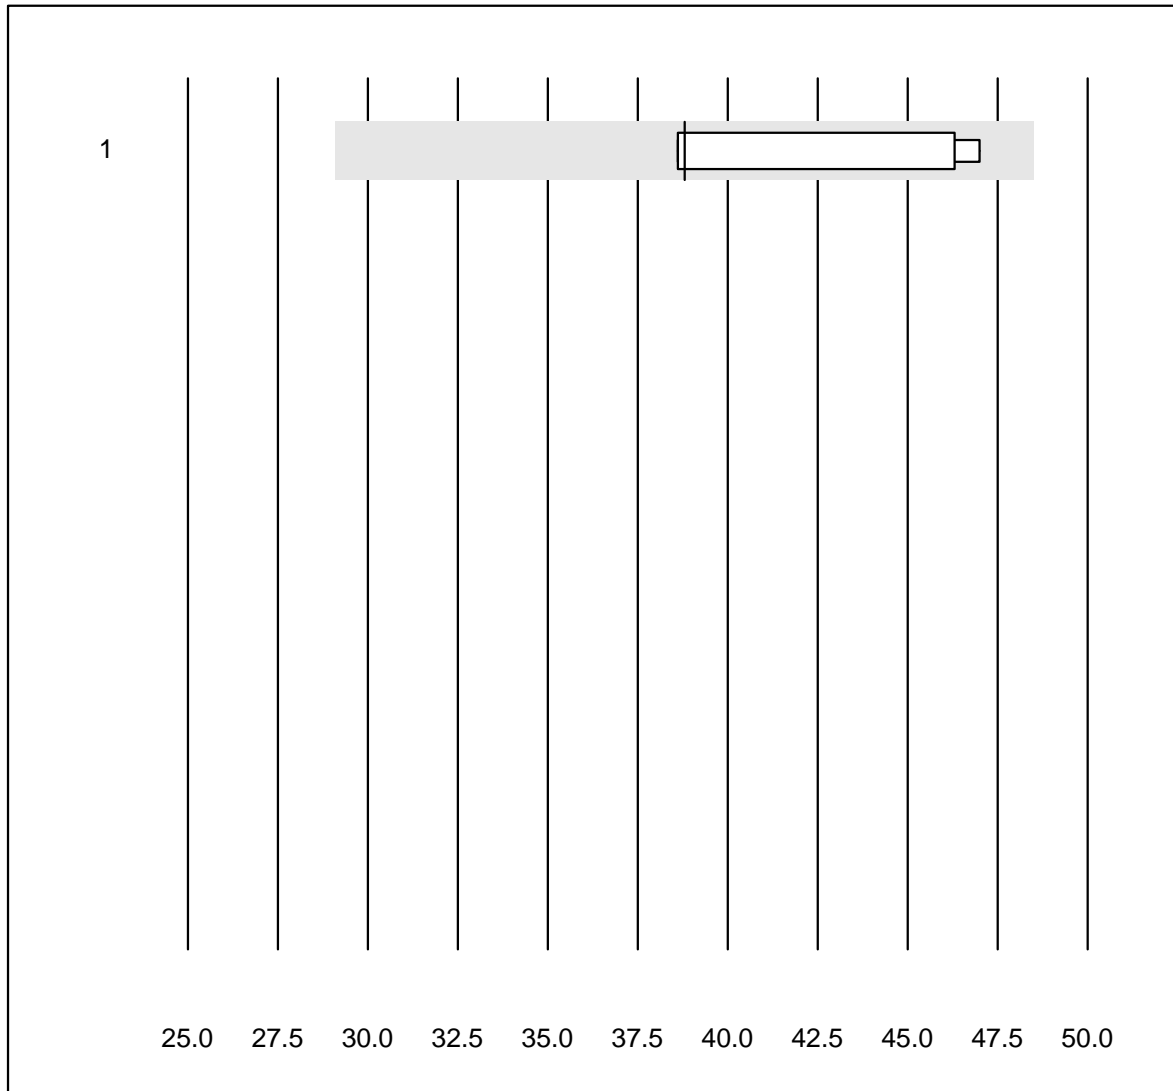


Tolérance QUALAB : 25 %

CA 15-3 (kIU/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Architect	4	100.0	0.0	0.0	38.8	9.3	a

AFP

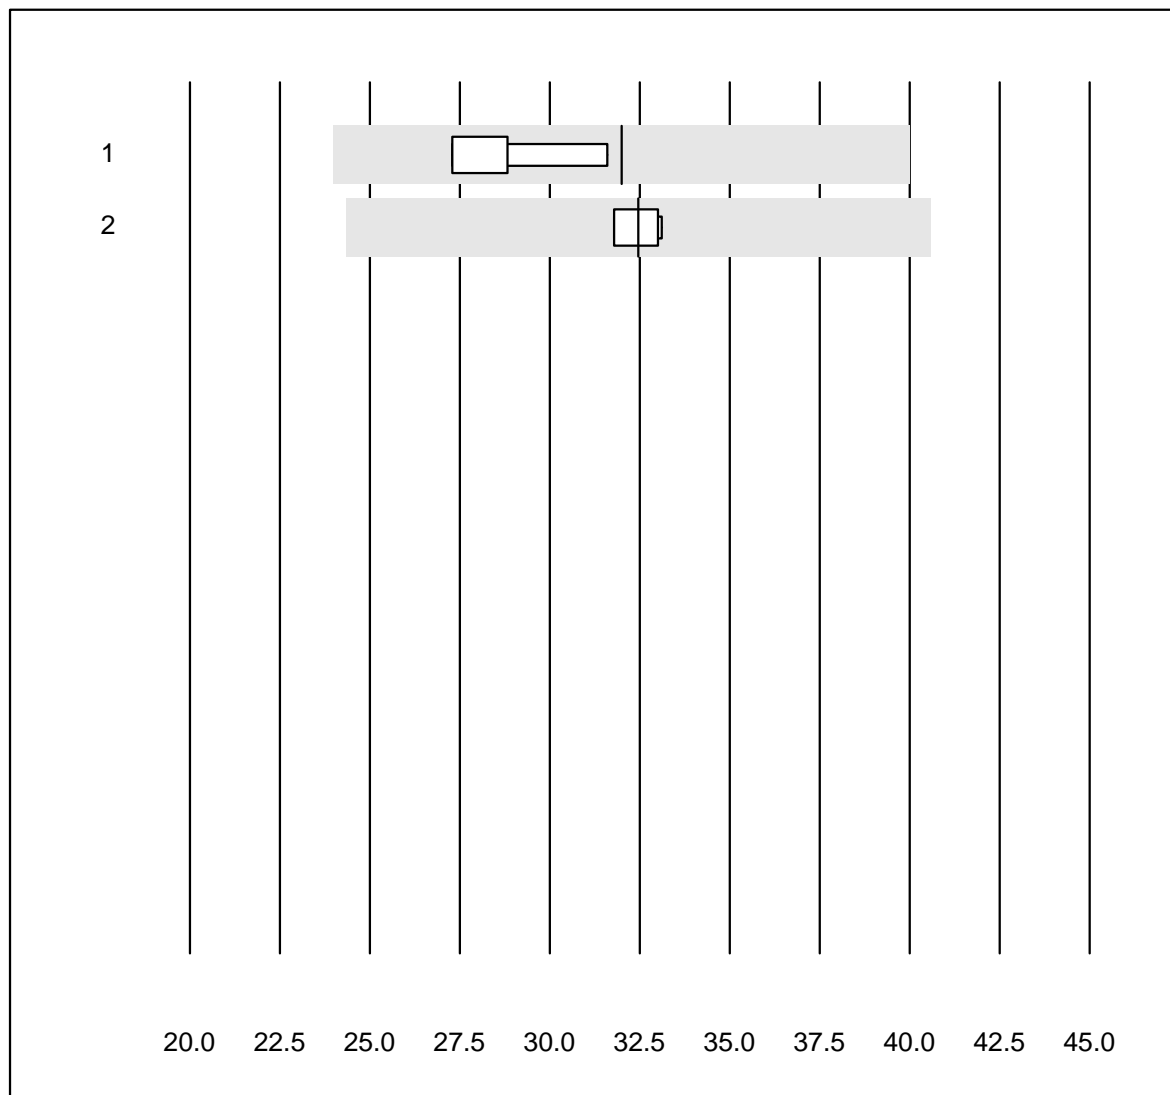


Tolérance QUALAB : 25 %

AFP (µg/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	4	100.0	0.0	0.0	32	6.5	a
2	Architect	4	100.0	0.0	0.0	32	2.1	a

HCG qn

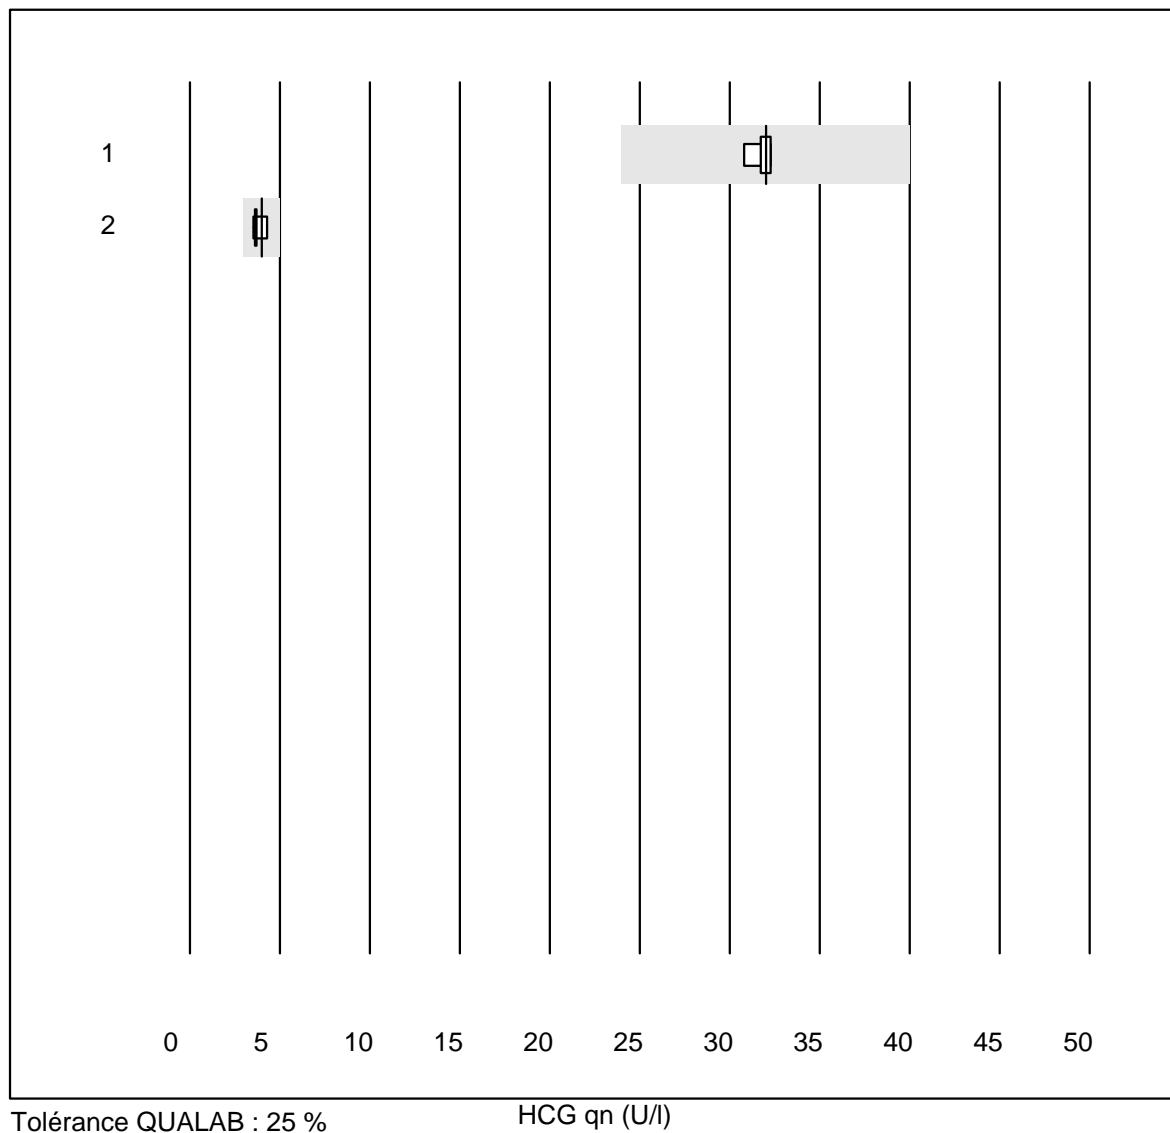

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	5	100.0	0.0	0.0	32	1.9	a
2	Vidas	5	100.0	0.0	0.0	4	7.9	a


pH OR

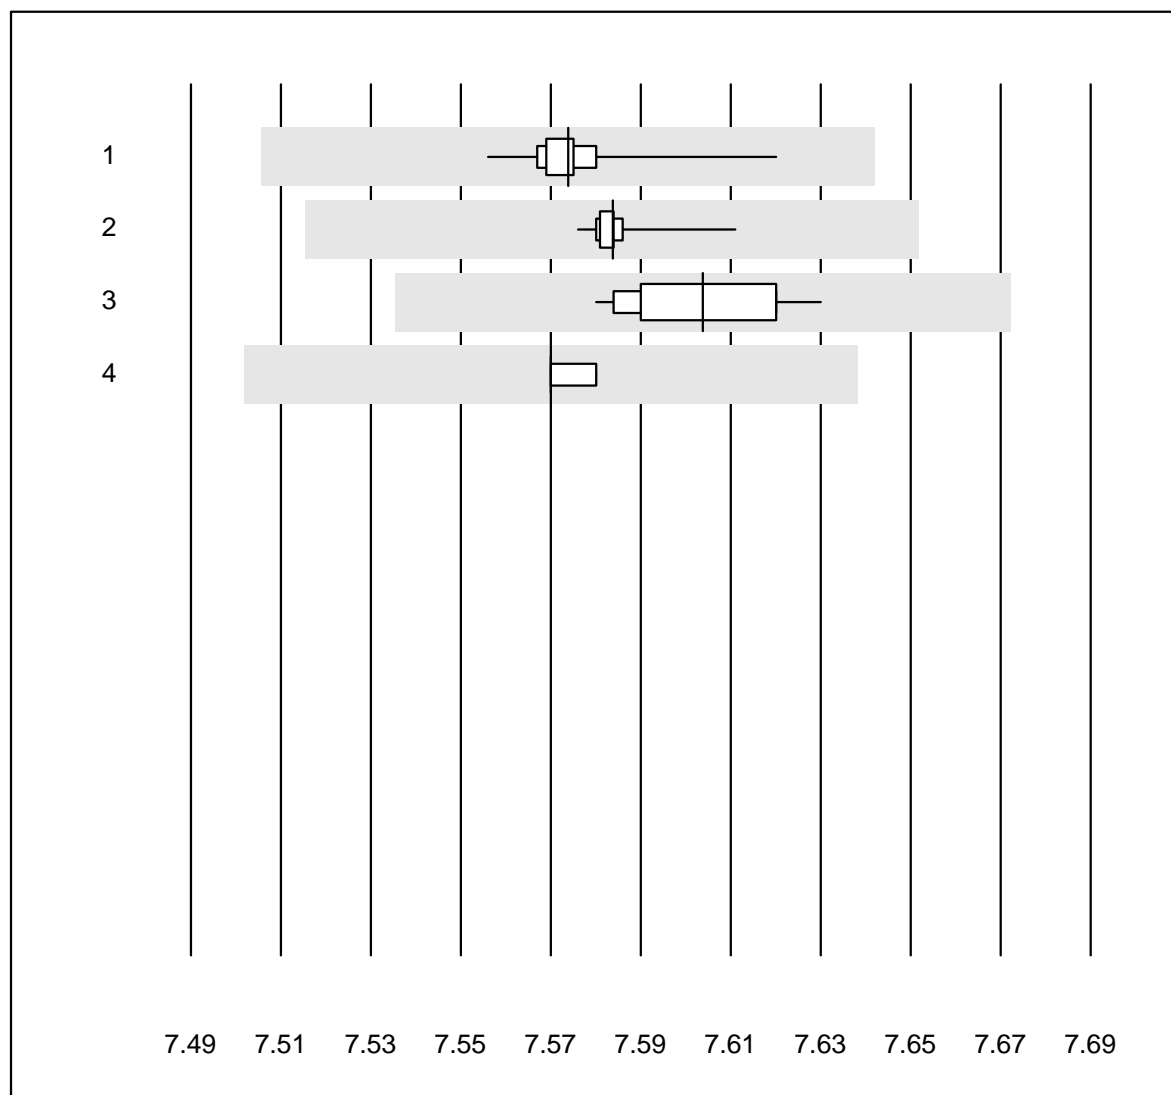

Tolérance QUALAB : 1 %


pH OR ()

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ABL700/800	80	100.0	0.0	0.0	7.57	0.1	e
2 ABL 90	33	100.0	0.0	0.0	7.58	0.1	e
3 ABL 80 / Coox	25	100.0	0.0	0.0	7.60	0.2	e
4 ABL 5	5	100.0	0.0	0.0	7.57	0.1	e

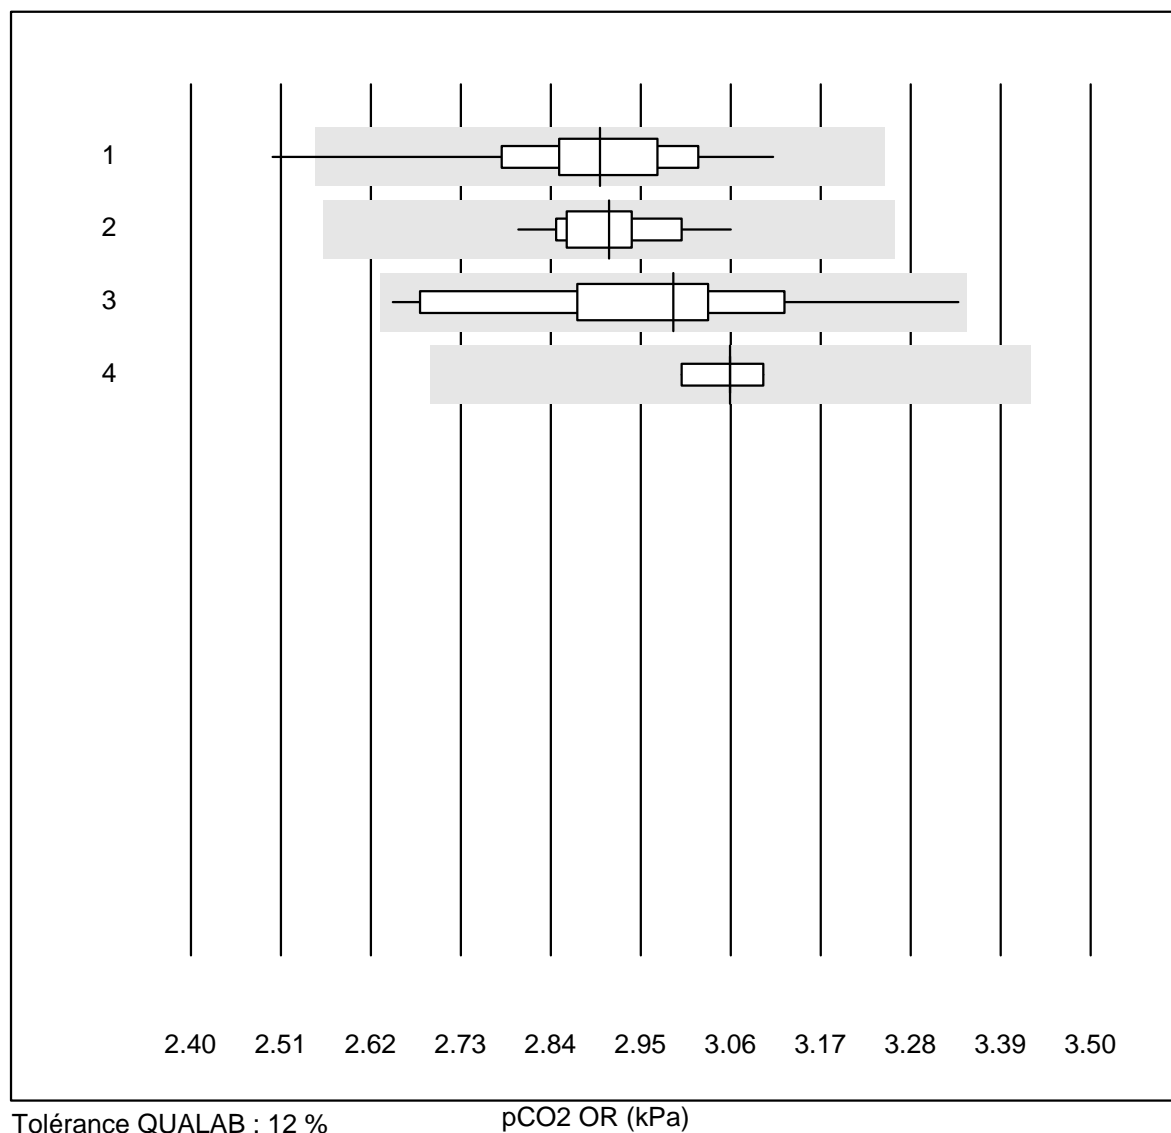pCO₂ OR


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ABL700/800	79	97.5	2.5	0.0	2.90	3.8	e
2 ABL 90	33	97.0	0.0	3.0	2.91	2.2	e
3 ABL 80 / Coox	25	92.0	0.0	8.0	2.99	5.5	e
4 ABL 5	5	100.0	0.0	0.0	3.06	1.2	e

pO2 OR

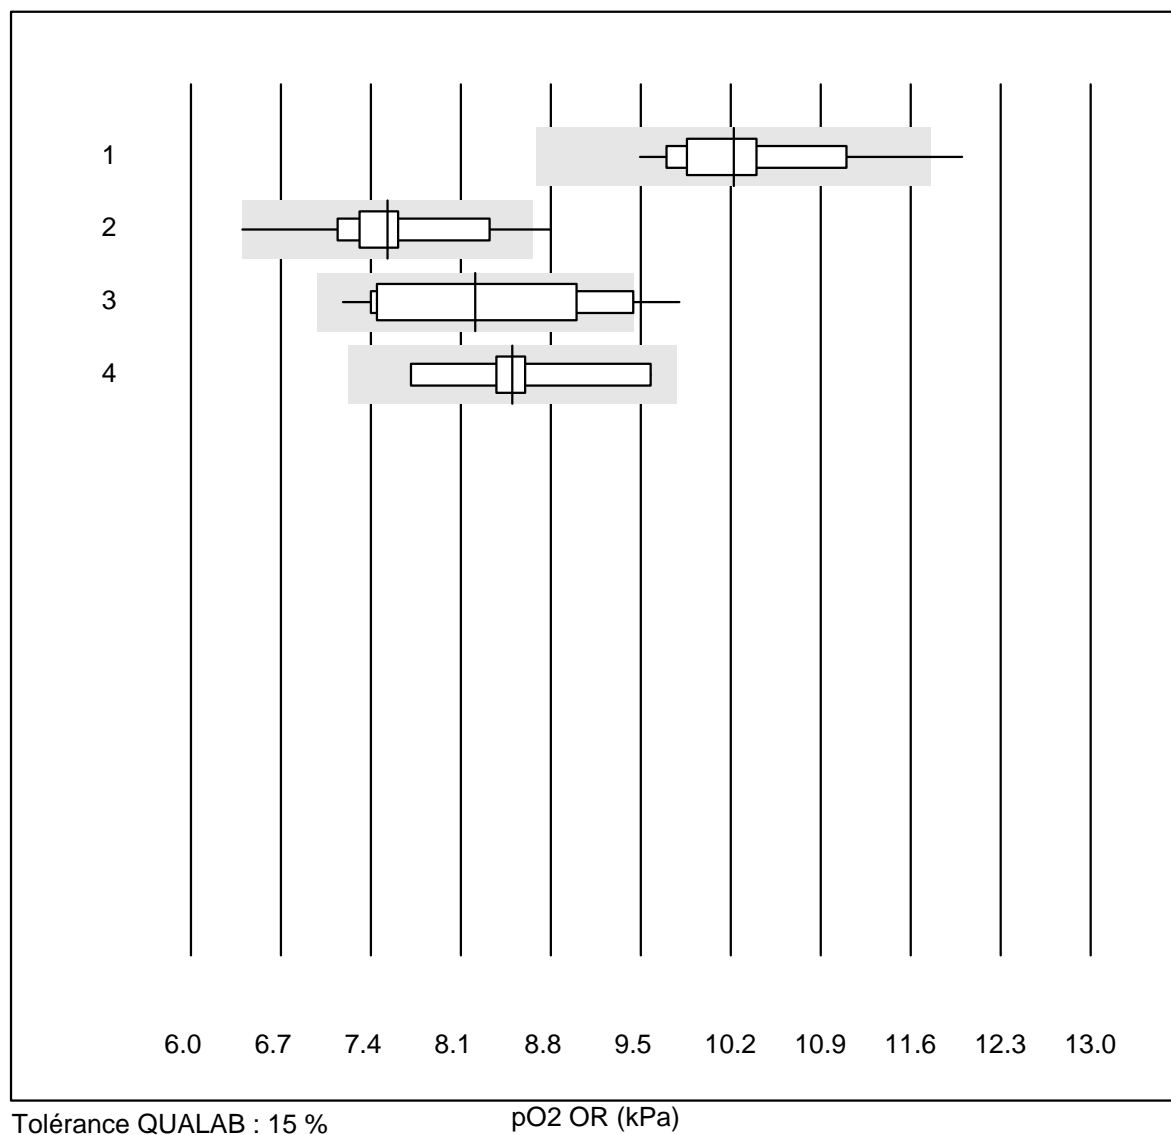


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ABL700/800	79	89.9	2.5	7.6	10.22	5.5	e
2 ABL 90	32	81.2	6.3	12.5	7.53	6.3	e
3 ABL 80 / Coox	25	76.0	8.0	16.0	8.21	10.8	e*
4 ABL 5	5	100.0	0.0	0.0	8.50	7.8	e*

ctHb OR

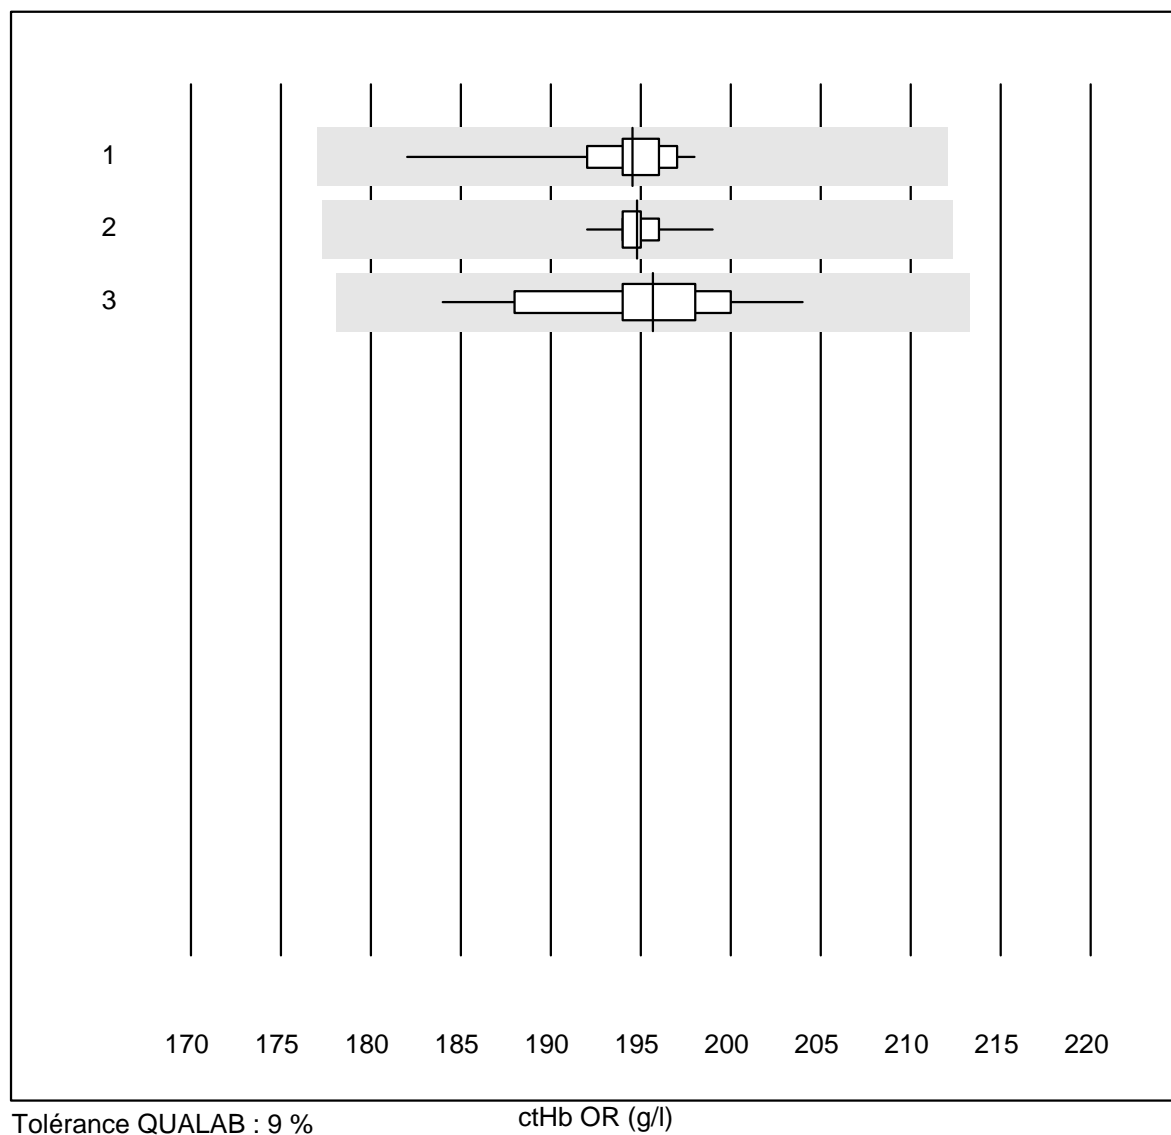

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ABL700/800	69	100.0	0.0	0.0	194.5	1.6	e
2 ABL 90	33	100.0	0.0	0.0	194.8	0.7	e
3 ABL 80 / Coox	17	88.2	0.0	11.8	195.7	2.4	e

sO2 OR

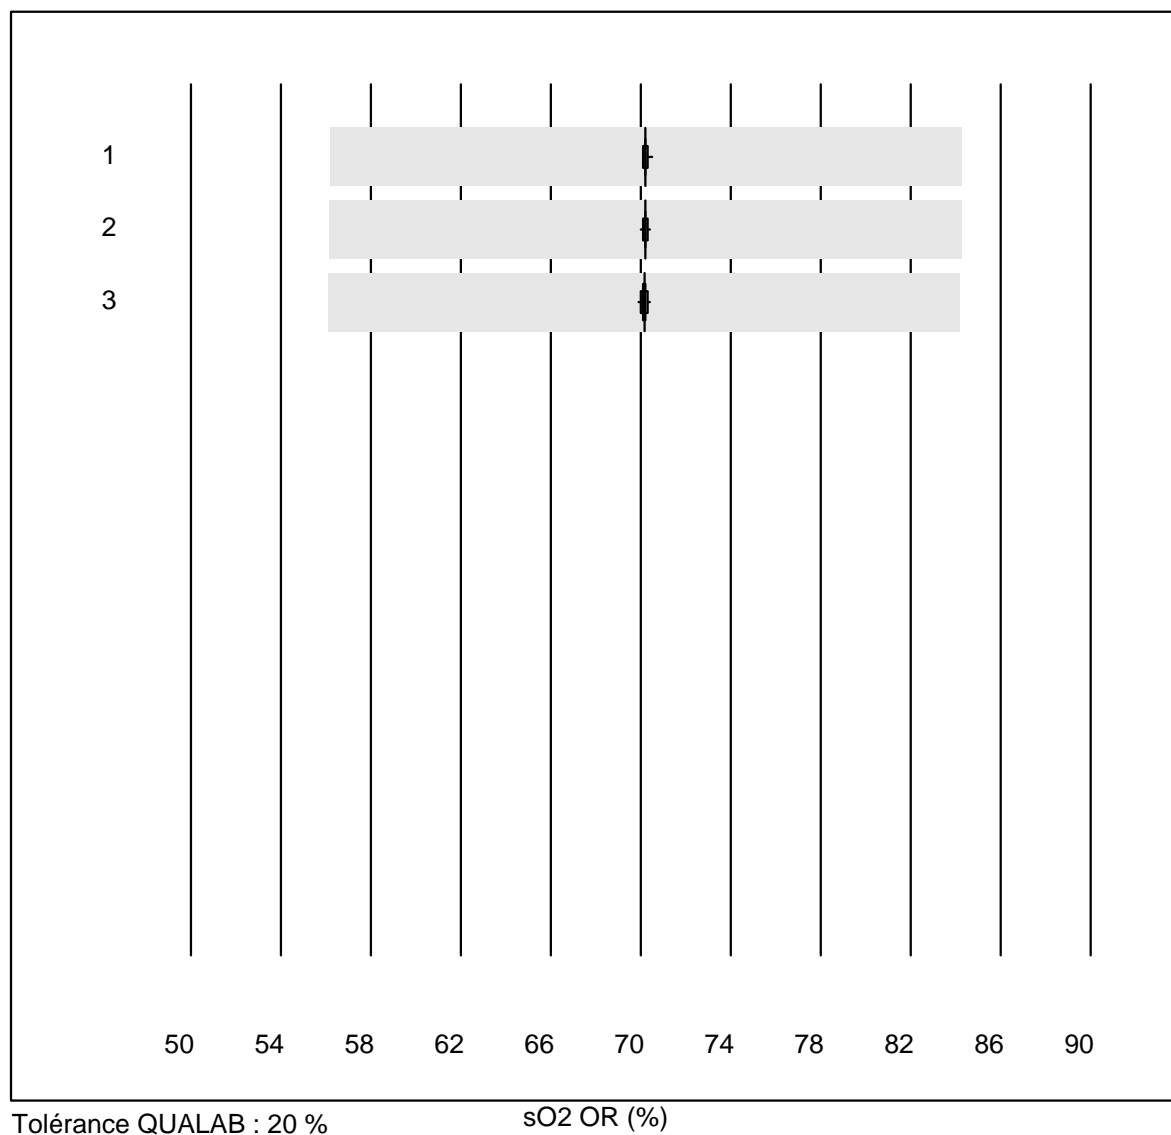


Tolérance QUALAB : 20 %

sO2 OR (%)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	ABL700/800	54	100.0	0.0	0.0	70.217	0.1	e
2	ABL 90	31	100.0	0.0	0.0	70.200	0.1	e
3	ABL 80 / Coox	15	86.7	0.0	13.3	70.154	0.2	e

FO2Hb OR

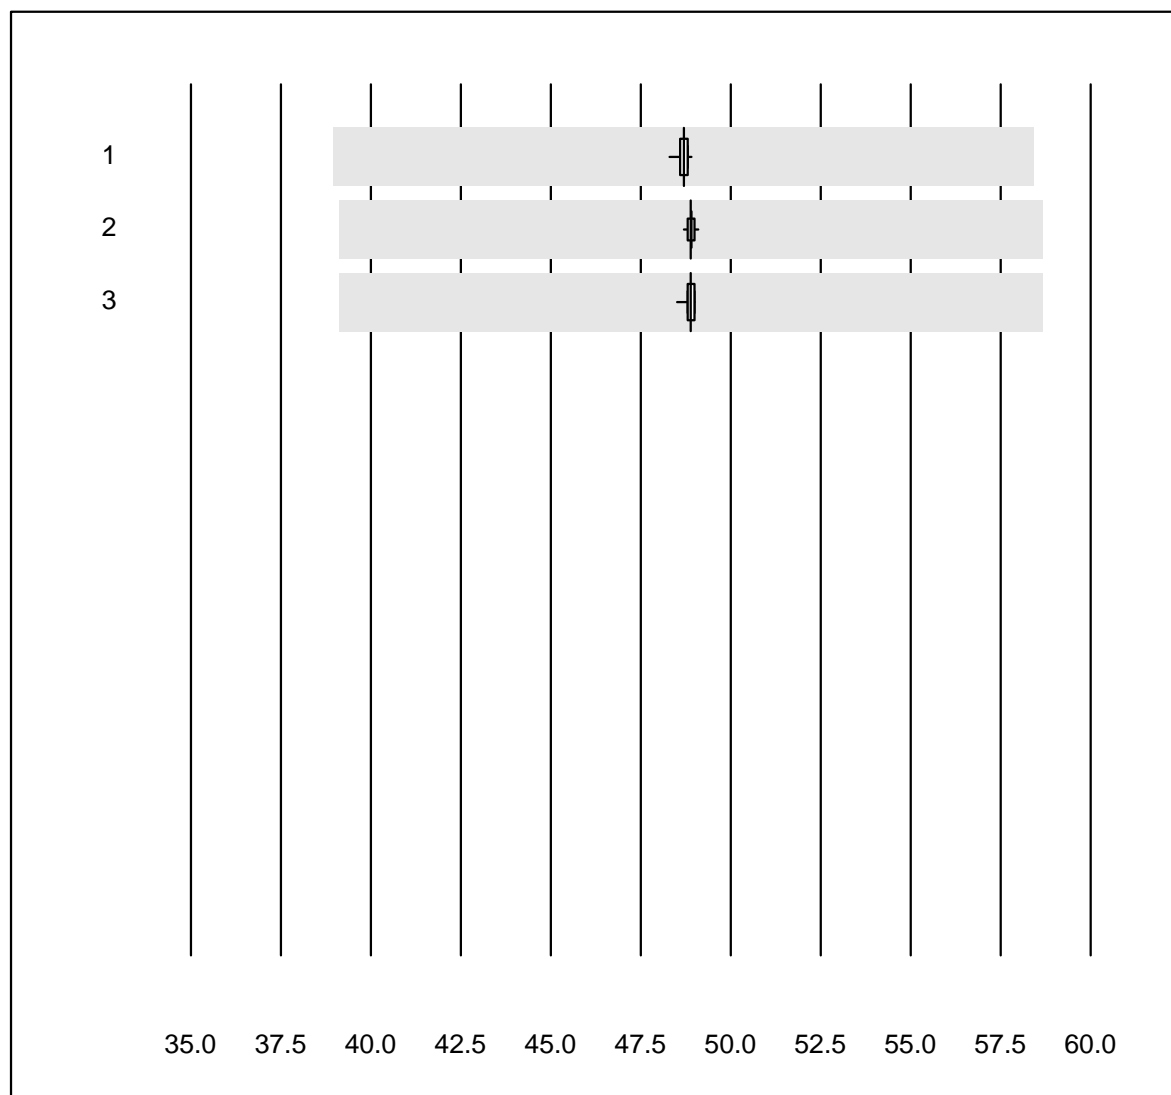


Tolérance QUALAB : 20 %

FO2Hb OR (%)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ABL700/800	49	100.0	0.0	0.0	48.692	0.2	e
2 ABL 90	32	100.0	0.0	0.0	48.897	0.2	e
3 ABL 80 / Coox	16	100.0	0.0	0.0	48.888	0.3	e

FCOHb OR

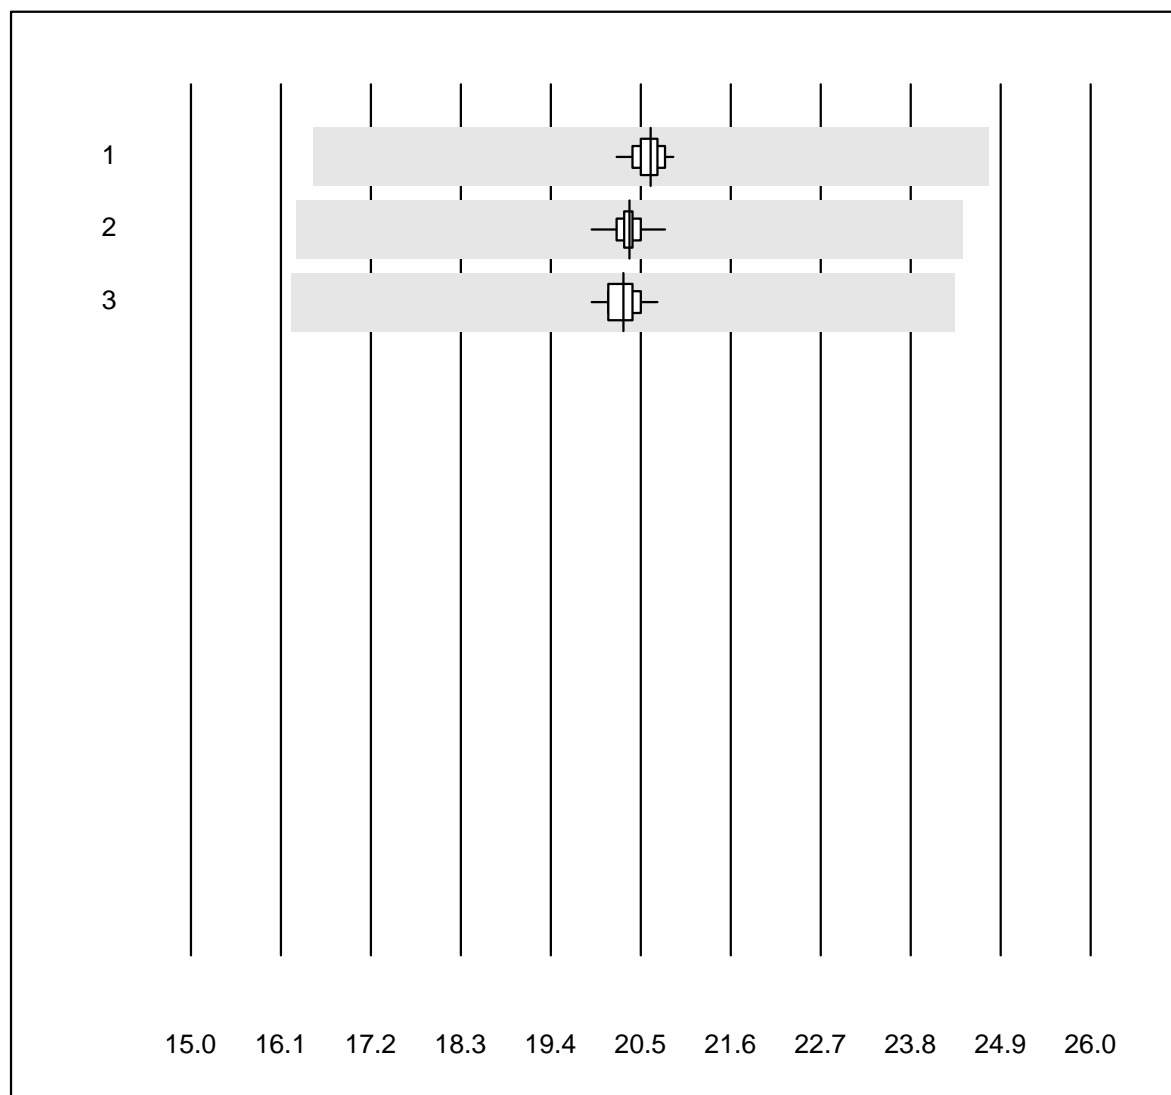


Tolérance QUALAB : 20 %

FCOHb OR (%)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ABL700/800	51	100.0	0.0	0.0	20.624	0.8	e
2 ABL 90	31	100.0	0.0	0.0	20.358	0.8	e
3 ABL 80 / Coox	16	100.0	0.0	0.0	20.288	1.0	e

FMetHb OR

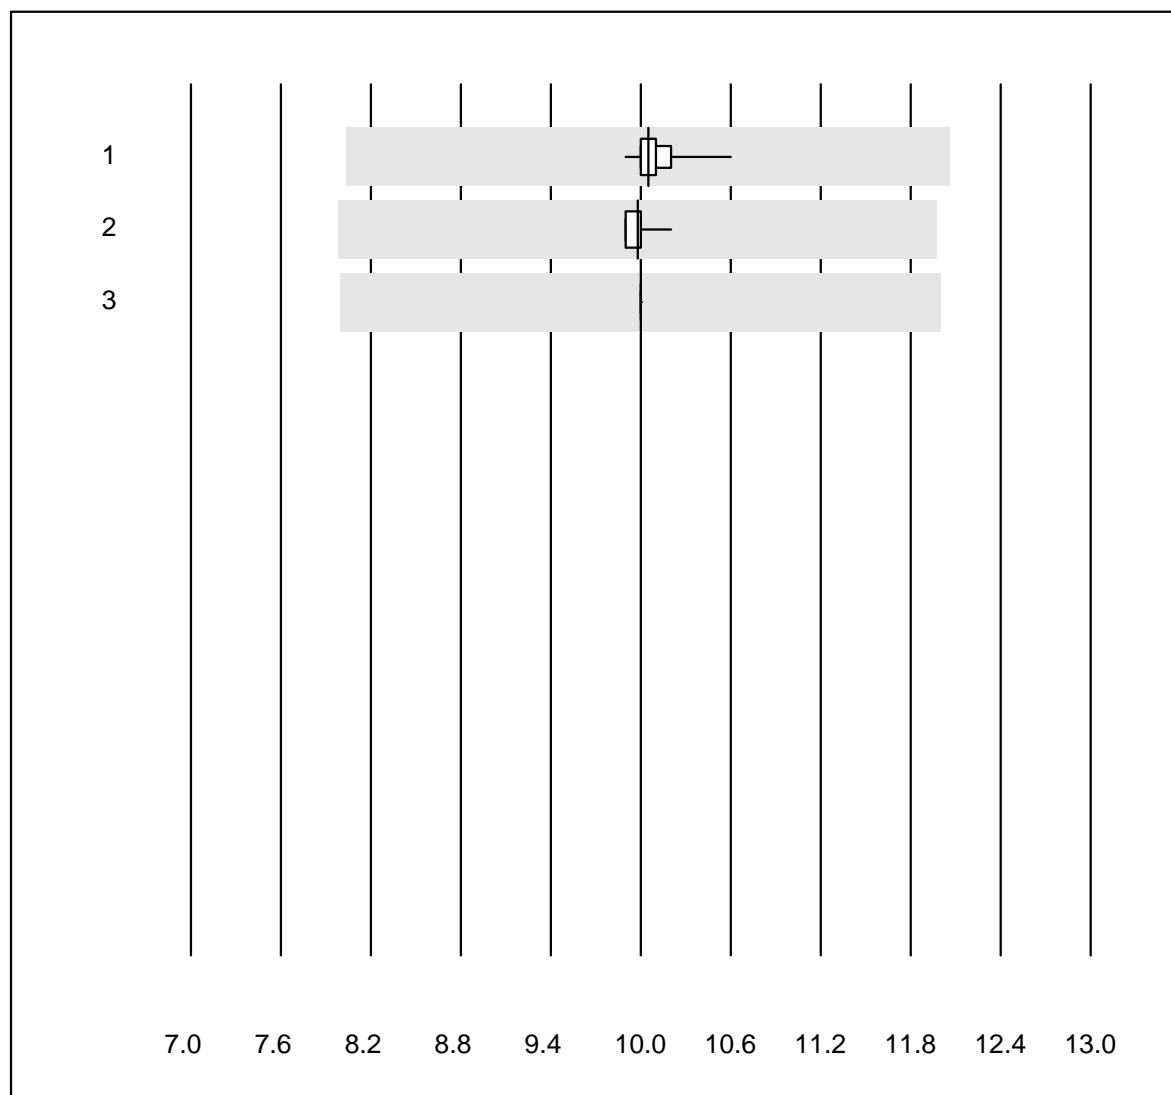


Tolérance QUALAB : 20 %

FMetHb OR (%)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ABL700/800	54	100.0	0.0	0.0	10.050	1.4	e
2 ABL 90	31	100.0	0.0	0.0	9.977	0.6	e
3 ABL 80 / Coox	16	100.0	0.0	0.0	10.000	0.0	e

FHHb

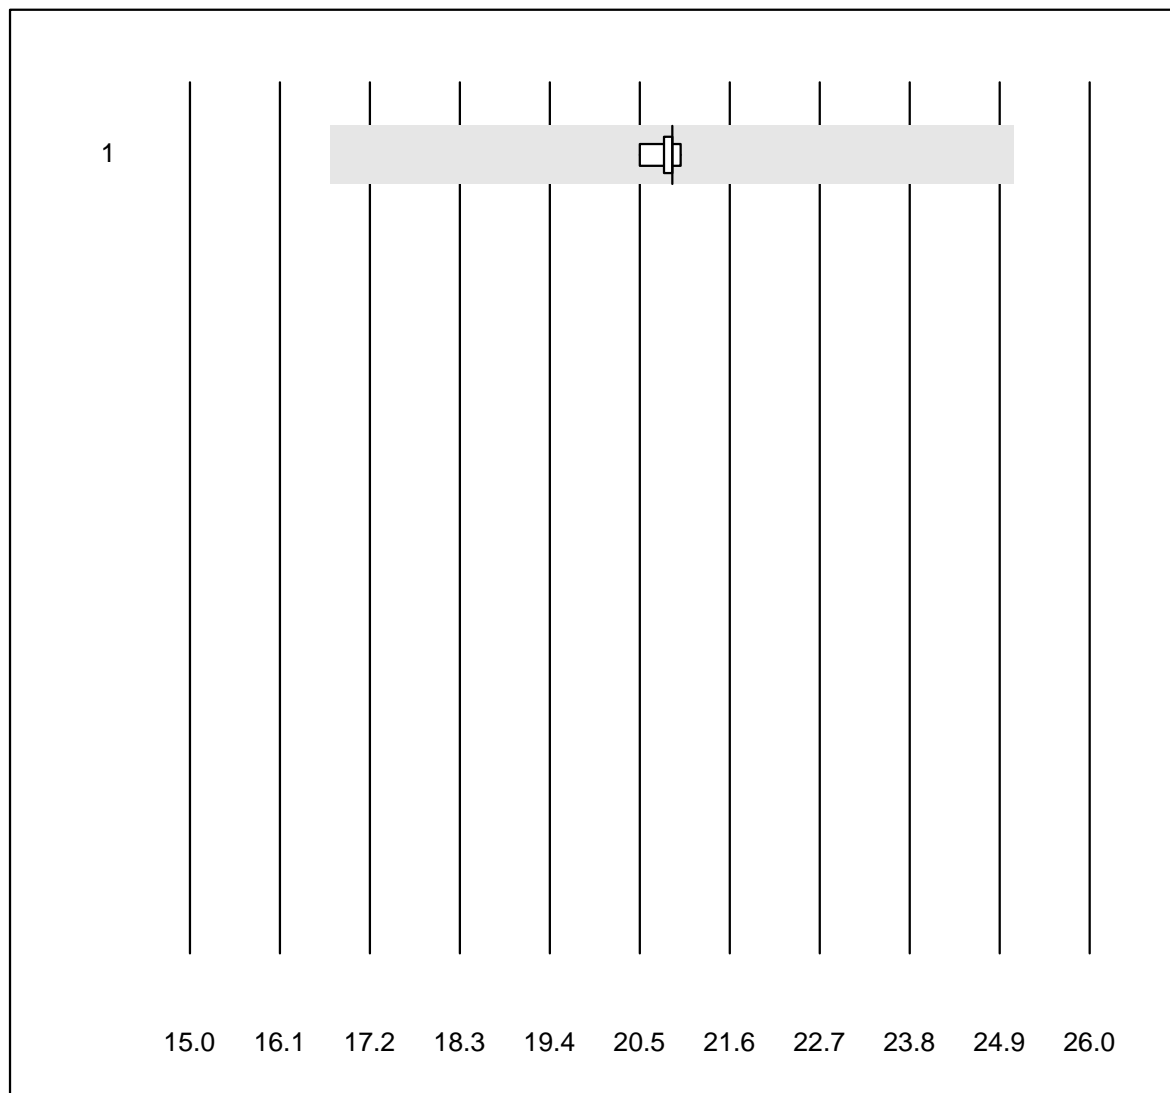


Tolérance QUALAB : 20 %

FHHb (%)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ABL 80 / Coox	6	100.0	0.0	0.0	20.900	0.8	e

FHbF OR

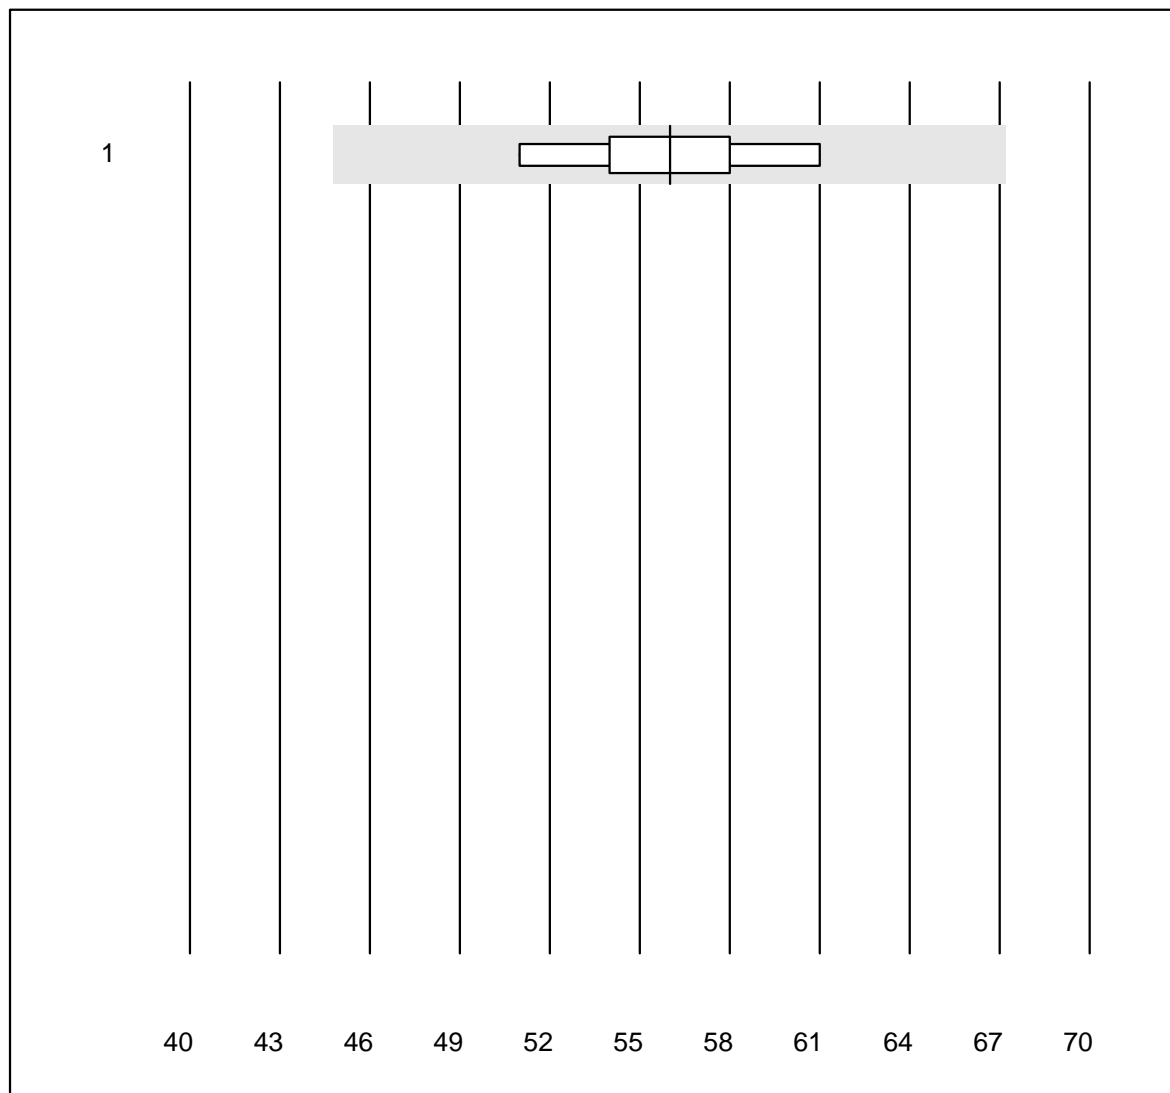


Tolérance QUALAB : 20 %

FHbF OR (%)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ABL 90	7	100.0	0.0	0.0	56.000	5.6	e

Bilirubin OR

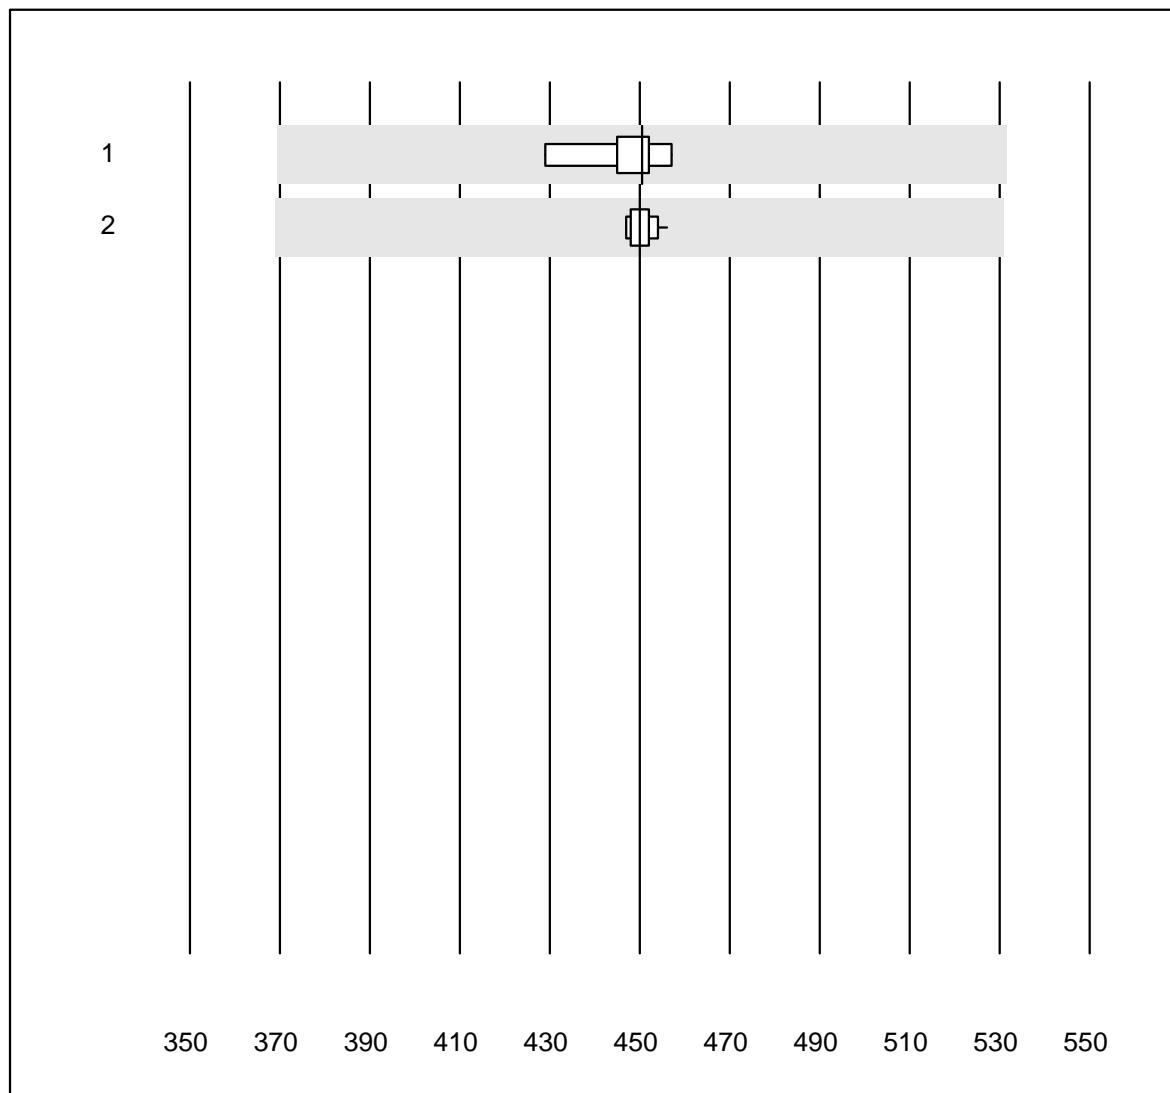


Tolérance QUALAB : 18 %

Bilirubin OR (µmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	ABL700/800	6	100.0	0.0	0.0	450.5	2.2	e
2	ABL 90	13	100.0	0.0	0.0	450.1	0.6	e

Kalium OR

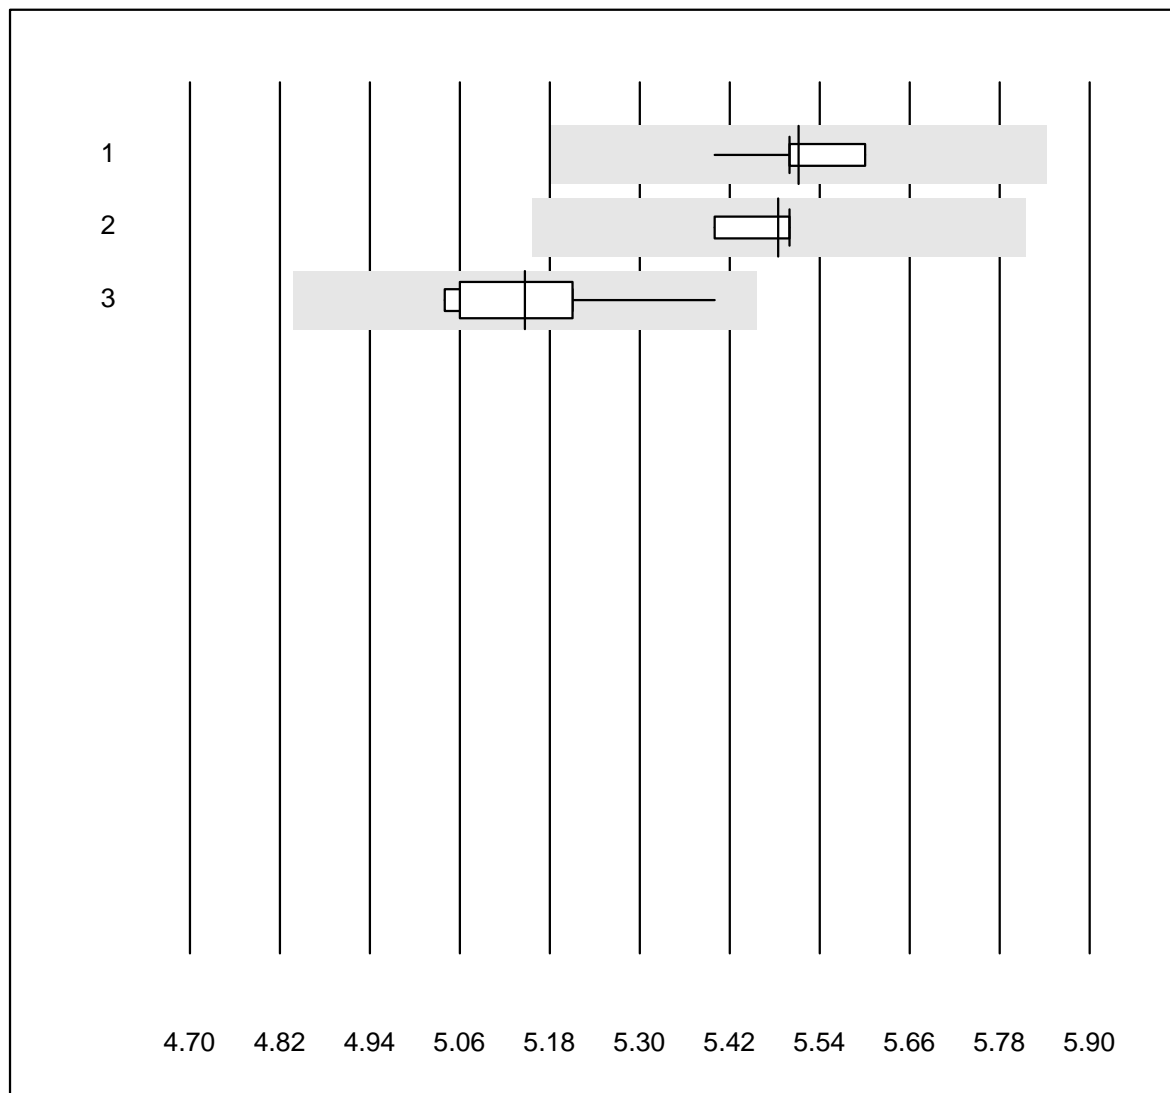


Tolérance QUALAB : 6 %

Kalium OR (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	ABL700/800	69	100.0	0.0	0.0	5.5	0.9	e
2	ABL 90	33	100.0	0.0	0.0	5.5	0.7	e
3	ABL 80 / Coox	10	100.0	0.0	0.0	5.1	2.1	e

Natrium OR

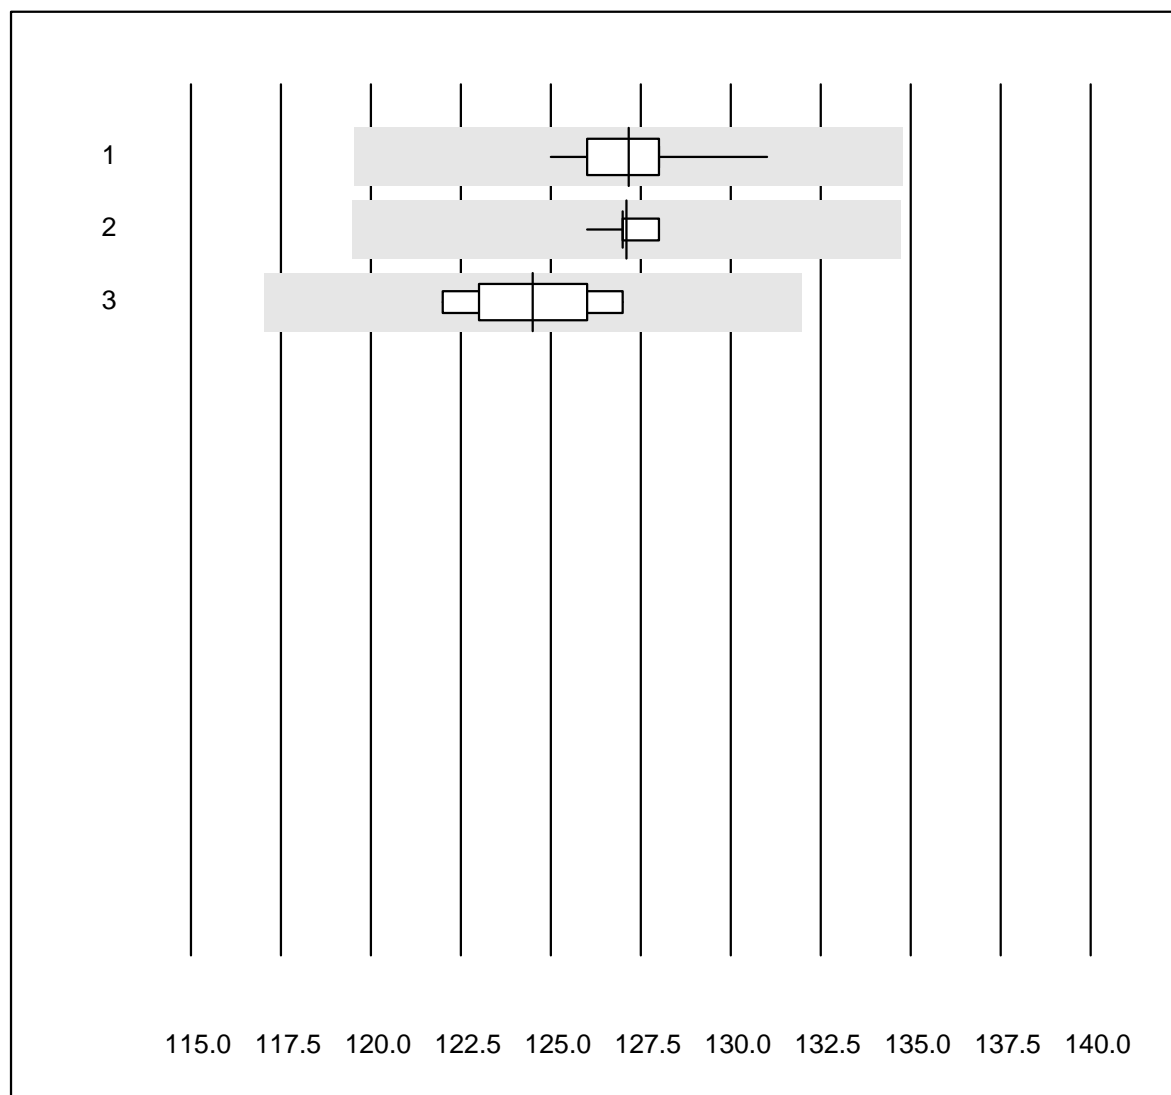


Tolérance QUALAB : 6 %

Natrium OR (mmol/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ABL700/800	66	100.0	0.0	0.0	127.2	0.8	e
2 ABL 90	33	100.0	0.0	0.0	127.1	0.3	e
3 ABL 80 / Coox	8	100.0	0.0	0.0	124.5	1.5	e

Kalzium OR

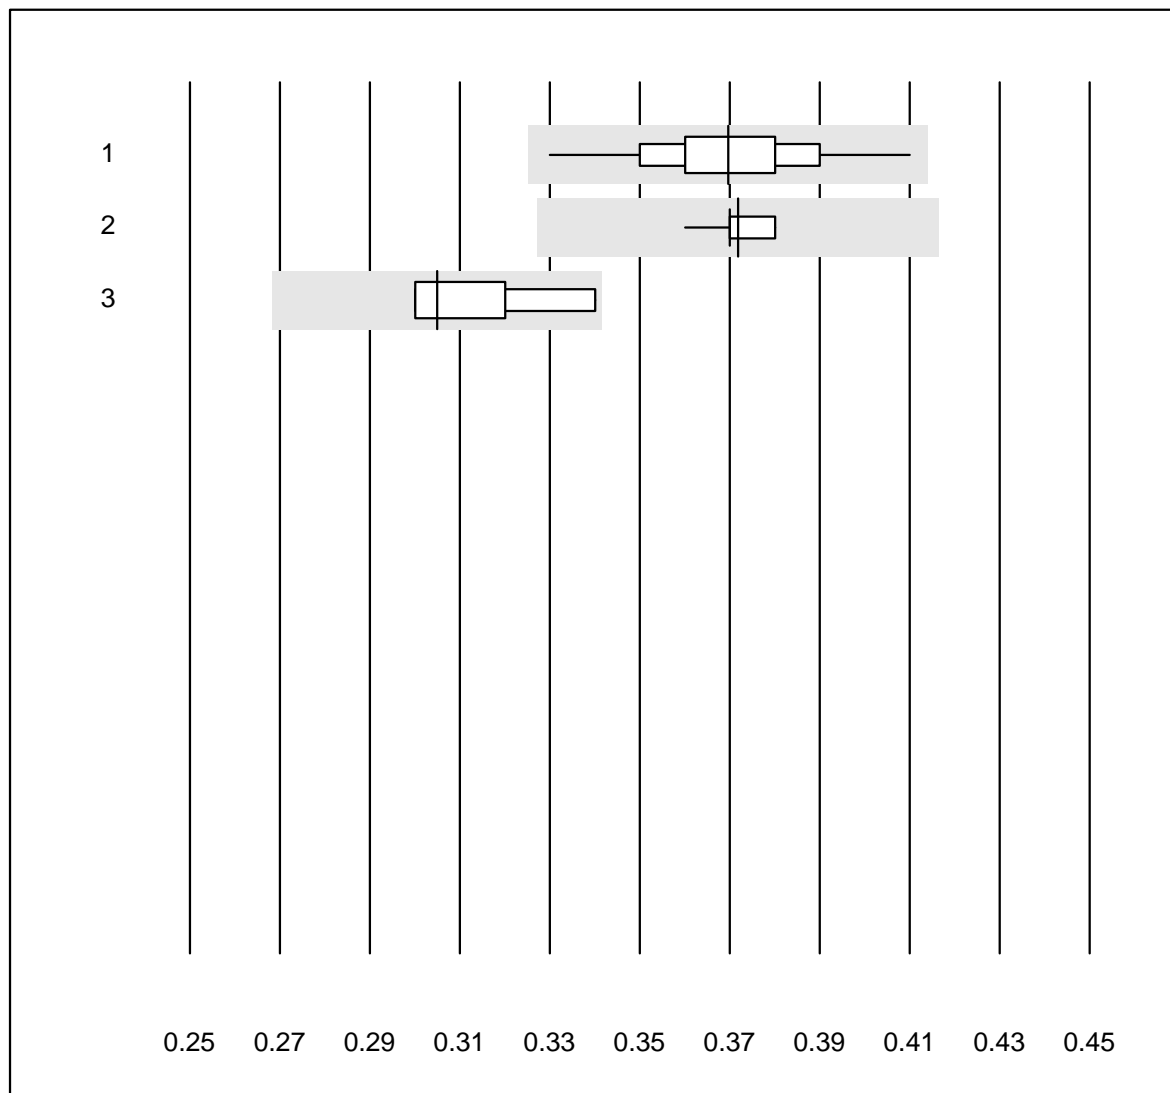


Tolérance QUALAB : 12 %

Kalzium OR (mmol/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ABL700/800	67	100.0	0.0	0.0	0.37	4.3	e
2 ABL 90	32	100.0	0.0	0.0	0.37	1.3	e
3 ABL 80 / Coox	8	75.0	0.0	25.0	0.31	4.8	e*

Chlorid OR

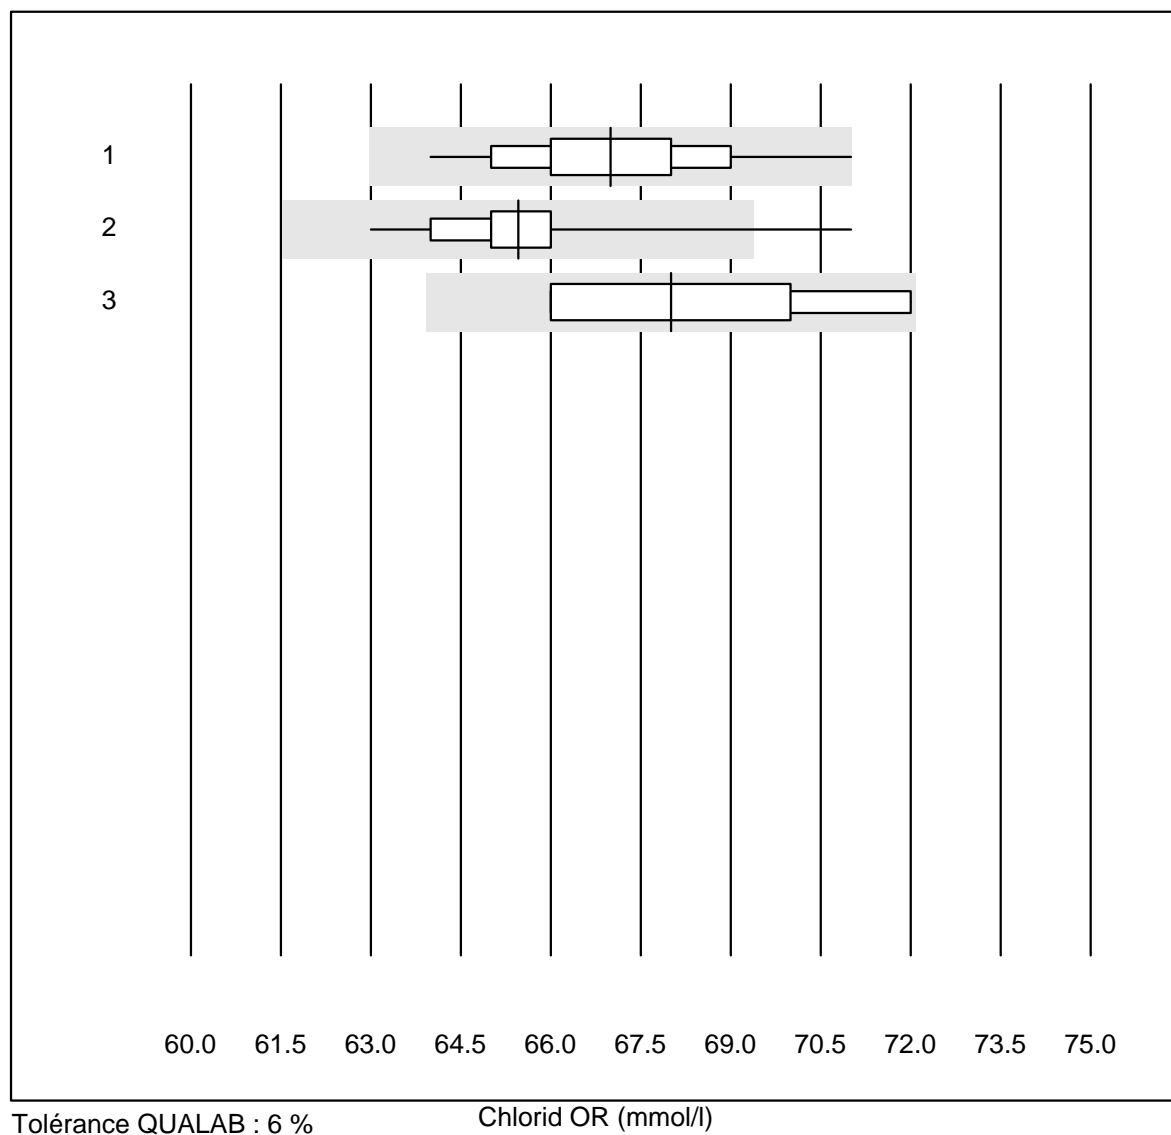


Tolérance QUALAB : 6 %

Chlorid OR (mmol/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ABL700/800	56	100.0	0.0	0.0	67.00	2.3	e
2 ABL 90	33	97.0	3.0	0.0	65.45	2.2	e
3 ABL 80 / Coox	7	100.0	0.0	0.0	68.00	3.2	e*

Glucose OR

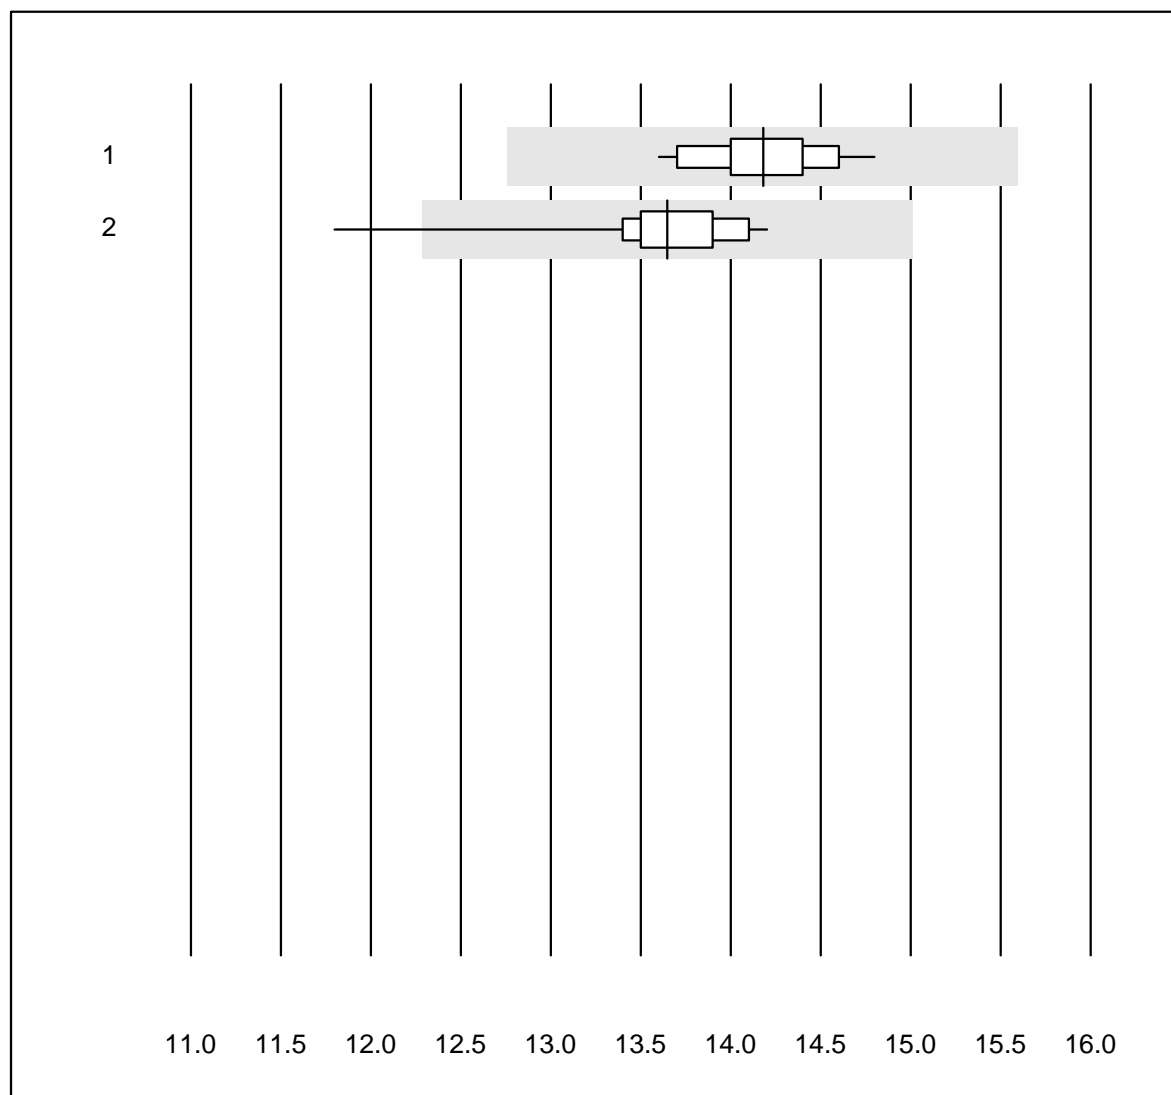


Tolérance QUALAB : 10 %

Glucose OR (mmol/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ABL700/800	67	100.0	0.0	0.0	14.2	2.2	e
2 ABL 90	34	94.2	2.9	2.9	13.6	3.4	e

Laktat OR

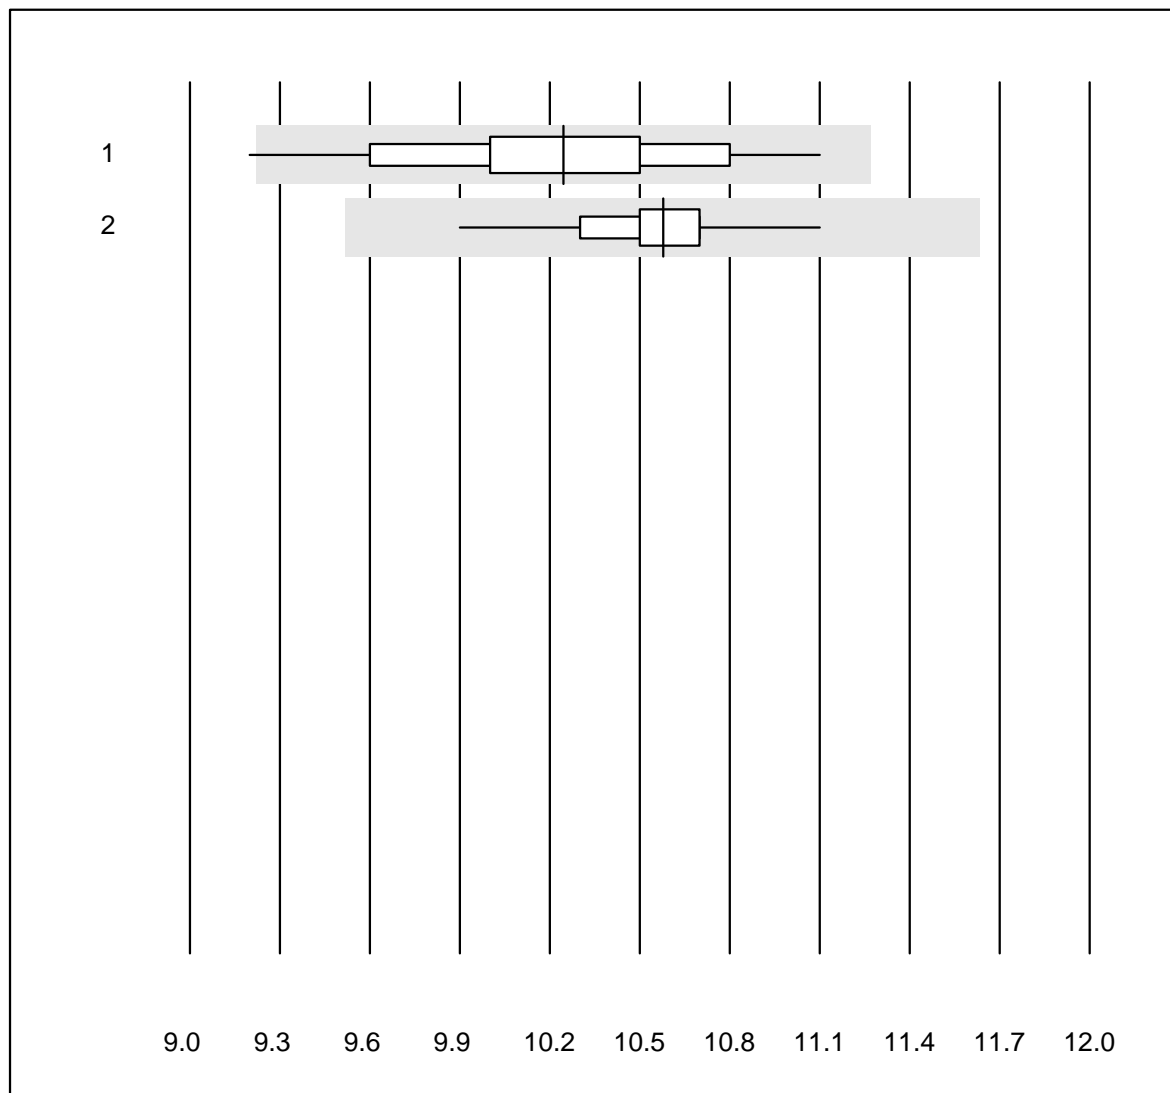


Tolérance QUALAB : 10 %

Laktat OR (mmol/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ABL700/800	71	95.8	1.4	2.8	10.24	3.9	e
2 ABL 90	32	96.9	0.0	3.1	10.58	2.5	e

BNP Plasma

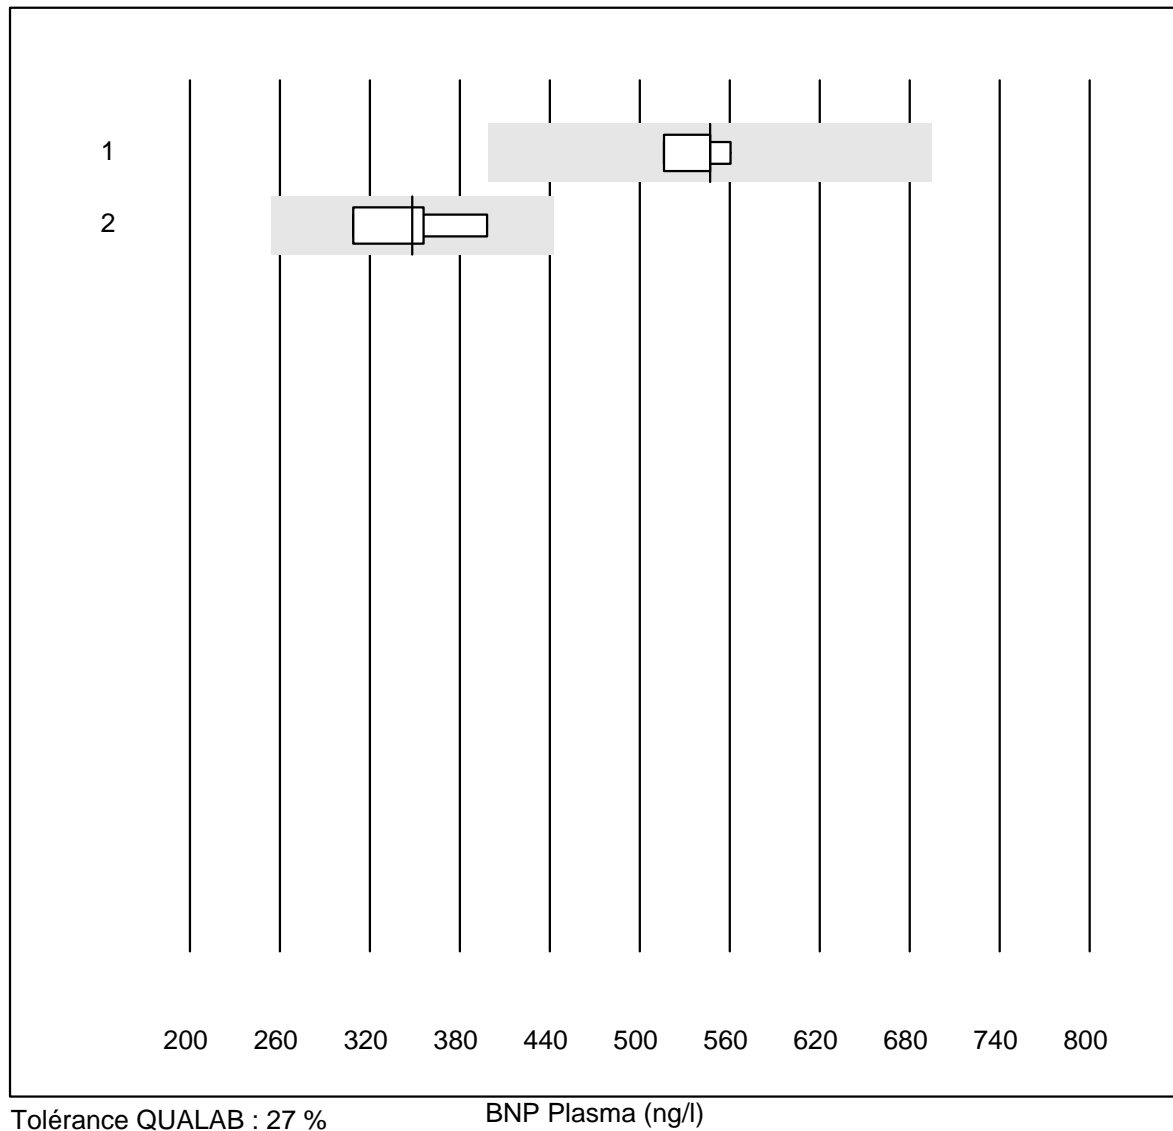


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	546.8	3.5	e
2	Architect	4	100.0	0.0	0.0	348.3	10.6	e*

NT-proBNP

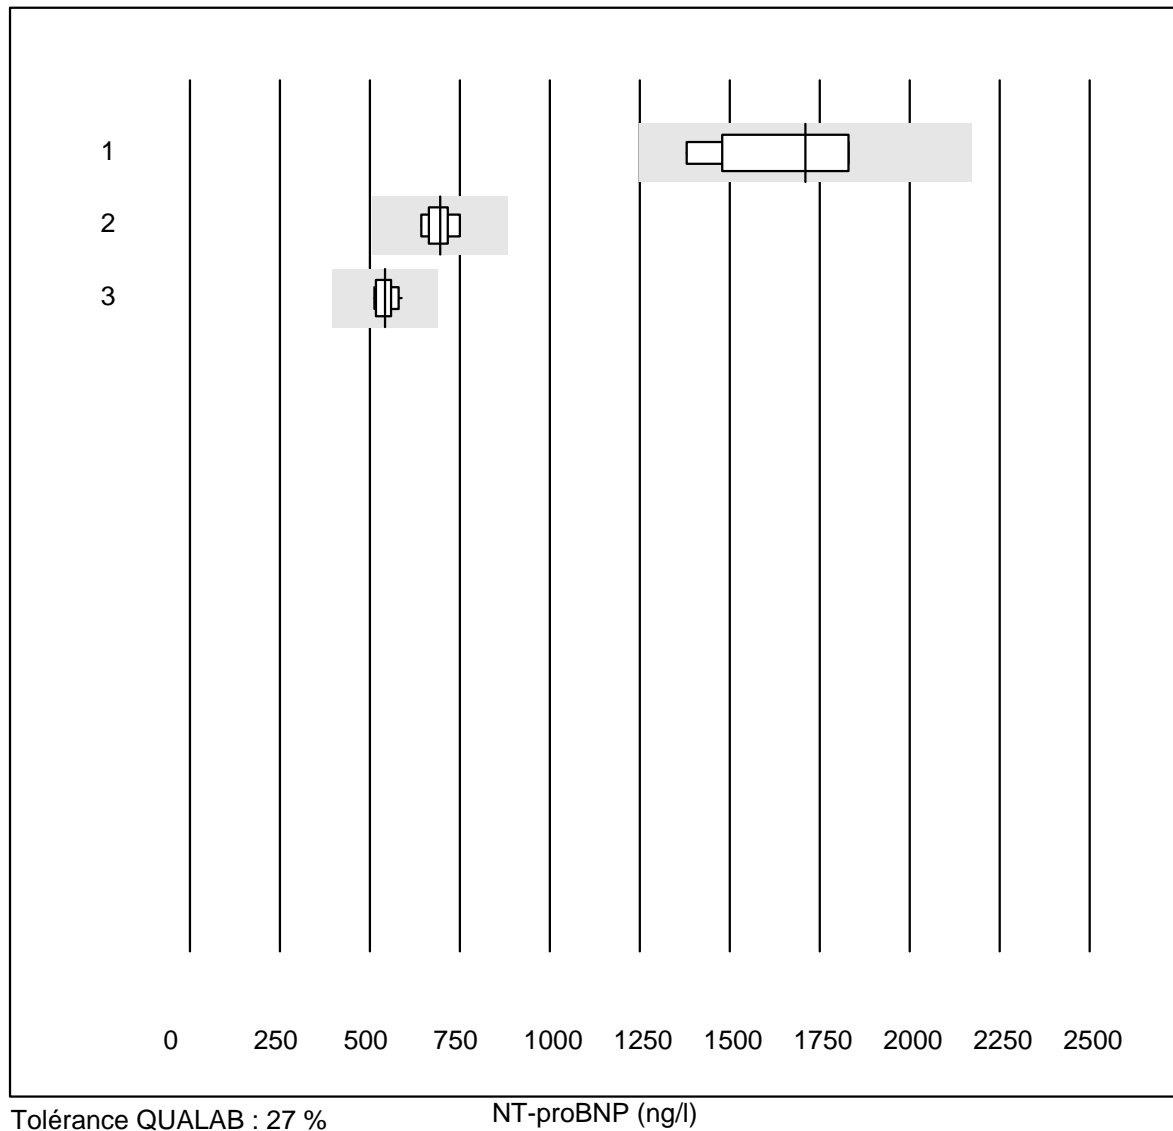

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	AQT 90 FLEX	8	87.5	0.0	12.5	1710.0	10.3	e*
2	Vidas	5	100.0	0.0	0.0	694.5	6.2	e
3	Cobas E / Elecsys	12	91.7	0.0	8.3	541.7	4.7	e

Cholesterin PTS

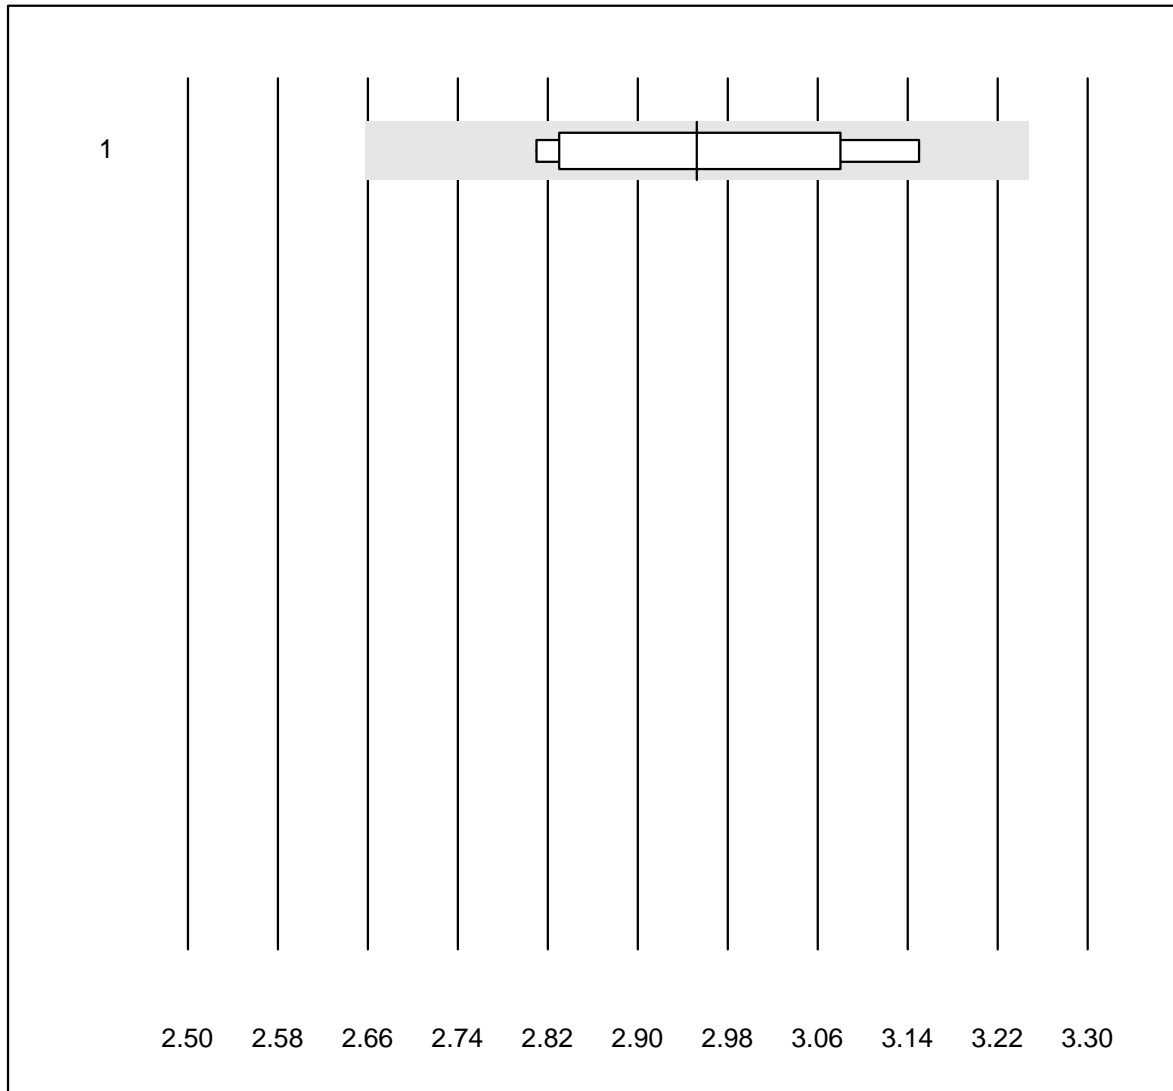


Tolérance QUALAB : 10 %

Cholesterin PTS (mmol/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 CardioChek	7	100.0	0.0	0.0	2.95	4.6	e*

Cholesterin HDL PTS

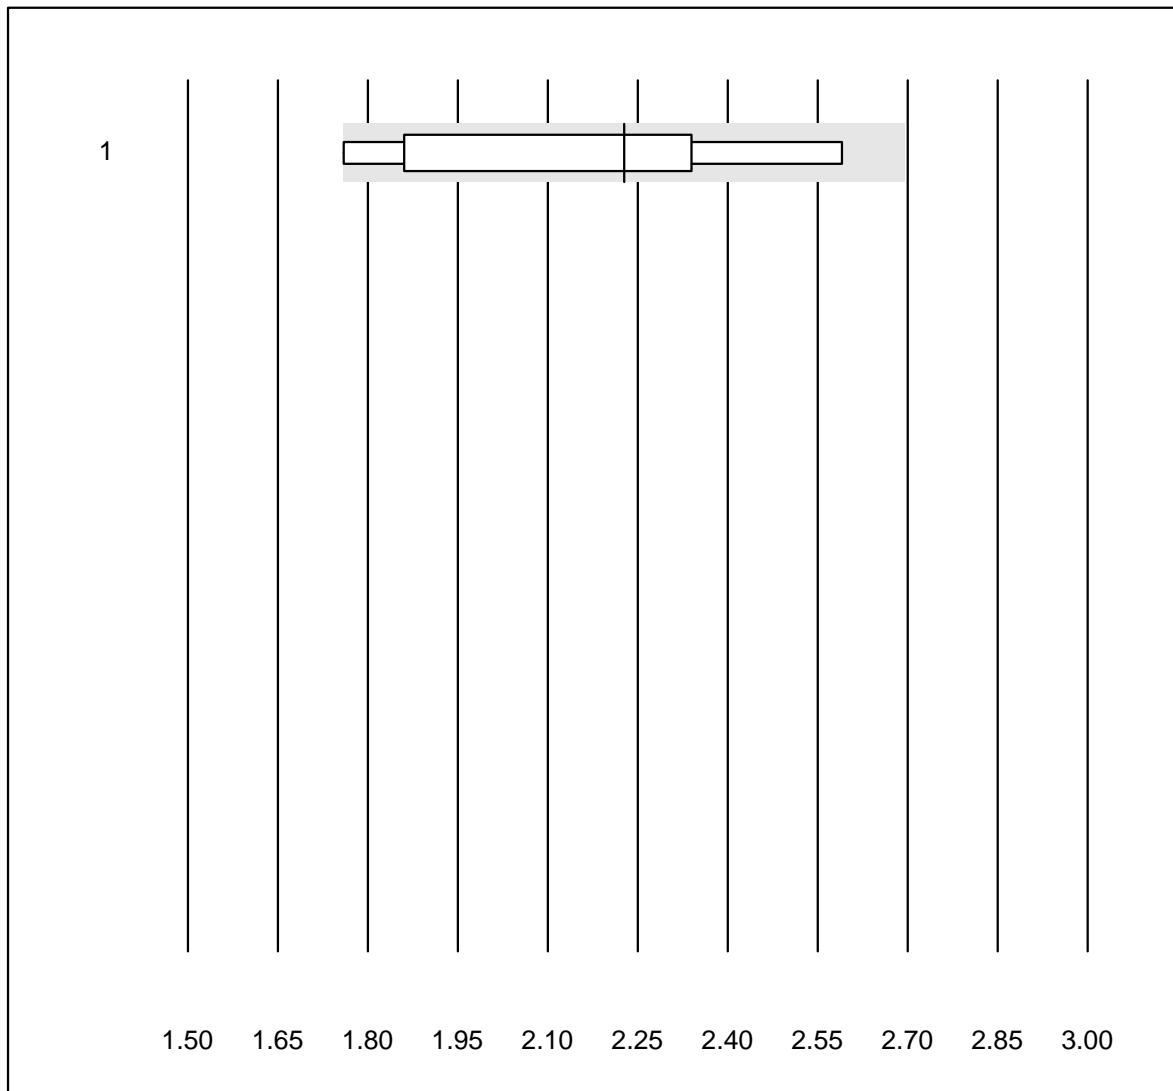


Tolérance QUALAB : 21 %

Cholesterin HDL PTS (mmol/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 CardioChek	7	100.0	0.0	0.0	2.23	13.5	e*

Triglyceride PTS

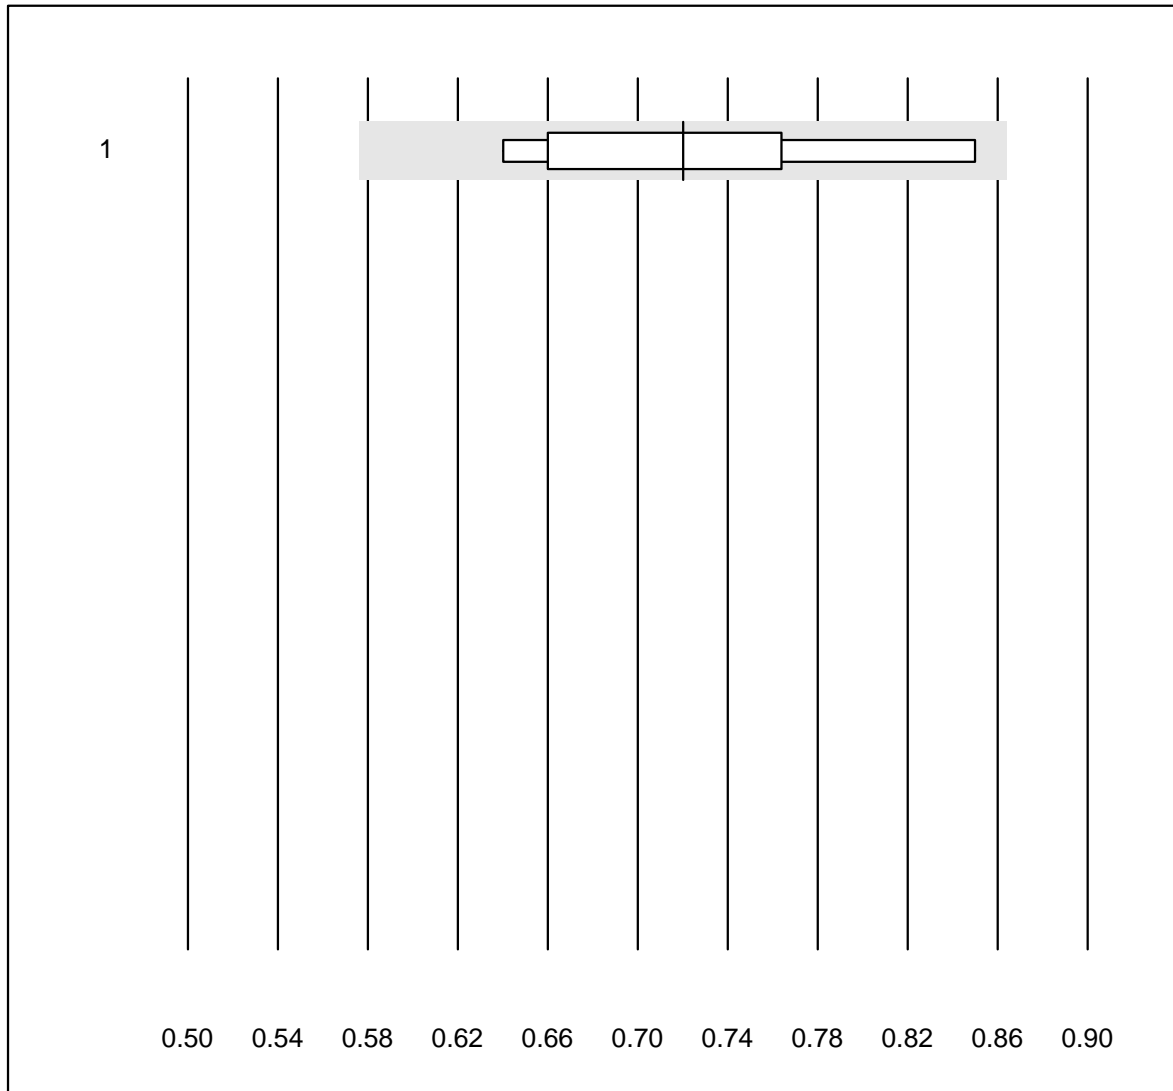


Tolérance QUALAB : 20 %

Triglyceride PTS (mmol/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 CardioChek	7	100.0	0.0	0.0	0.72	9.5	e*

Microalbumine

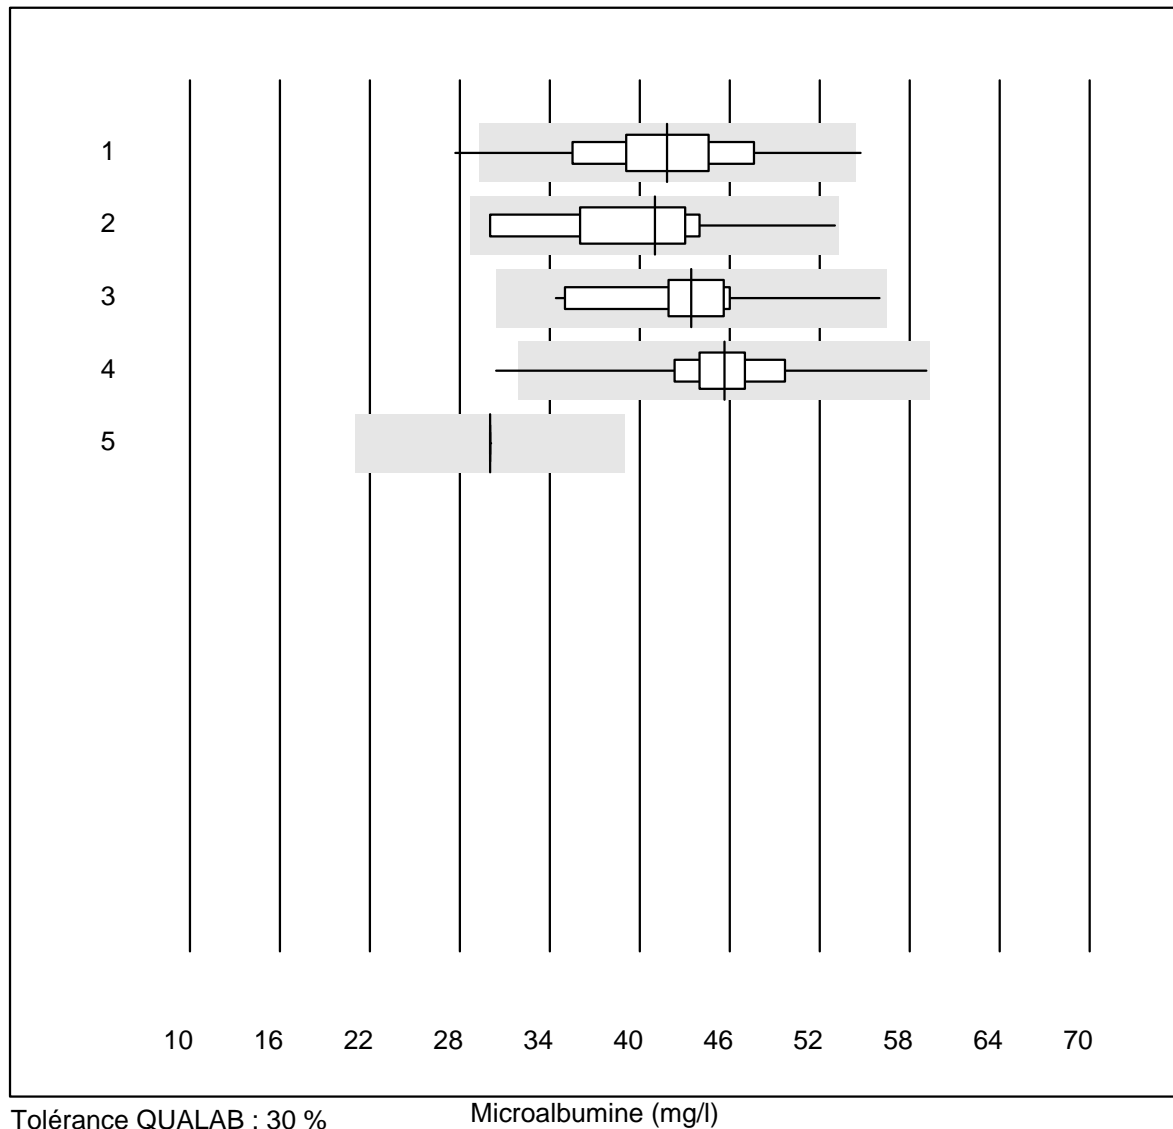

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Afinion	349	96.0	1.1	2.9	41.8	11.2	e
2 NycoCard	10	100.0	0.0	0.0	41.0	15.7	e*
3 Turbidimetrie	20	100.0	0.0	0.0	43.4	11.3	e
4 DCA2000/Vantage	130	95.4	0.8	3.8	45.7	6.9	e
5 Siemens Clinitek	15	73.3	0.0	26.7	30.0	0.0	e

Créatinine U

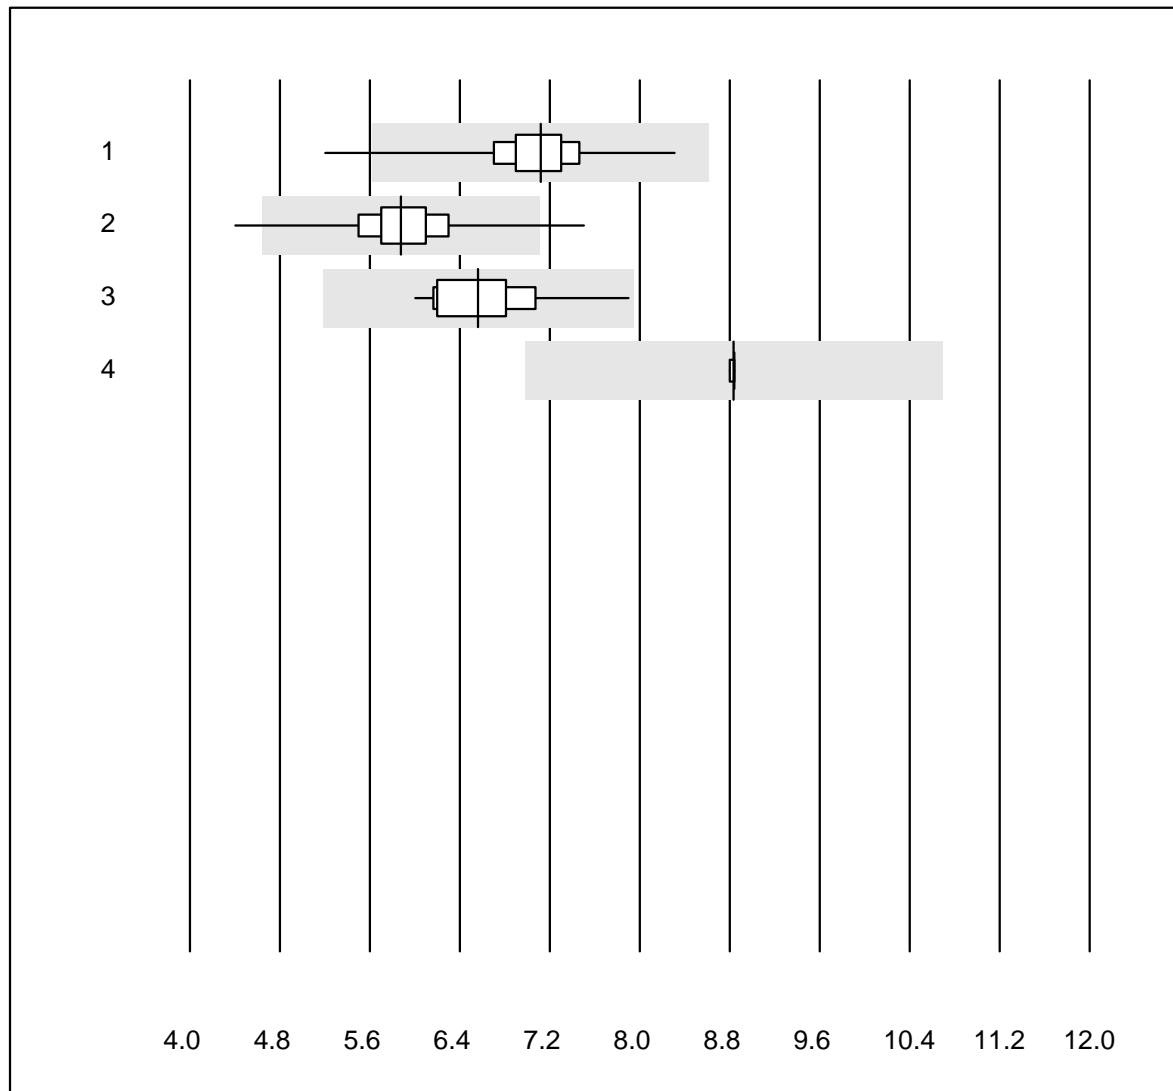


Tolérance QUALAB : 21 %

Créatinine U (mmol/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	DCA2000/Vantage	130	93.8	0.8	5.4	7.1	5.1	e
2	Afinion	348	97.8	1.1	1.1	5.9	6.2	e
3	Chimie humide	32	100.0	0.0	0.0	6.6	6.6	e
4	Siemens Clinitek	14	78.6	0.0	21.4	8.8	0.2	e

INR CCXS

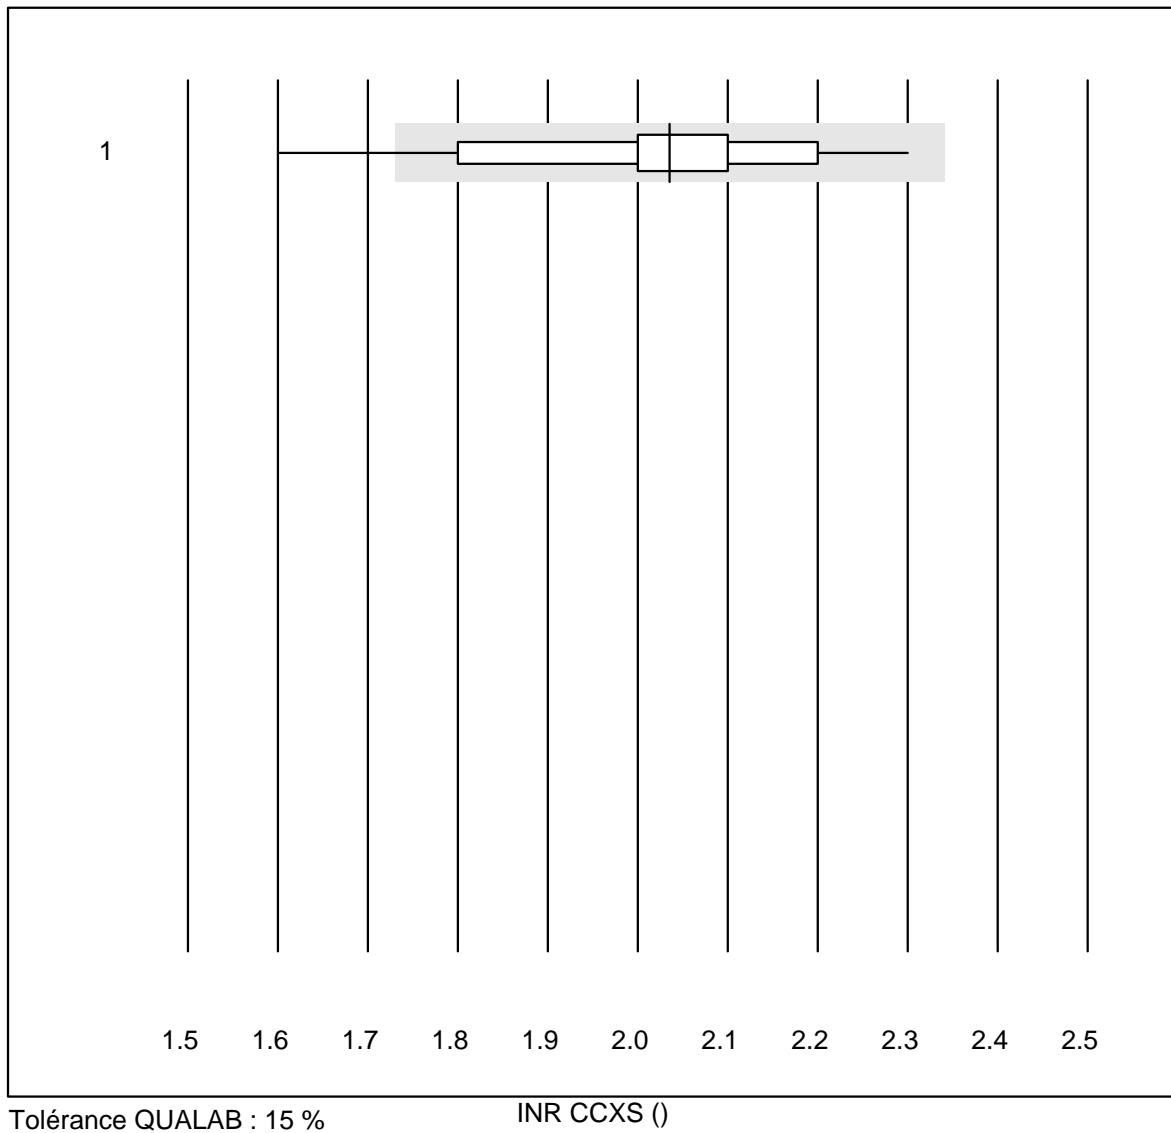

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 CoaguChek XS	2290	97.6	1.5	0.9	2.0	6.4	e

INR HC

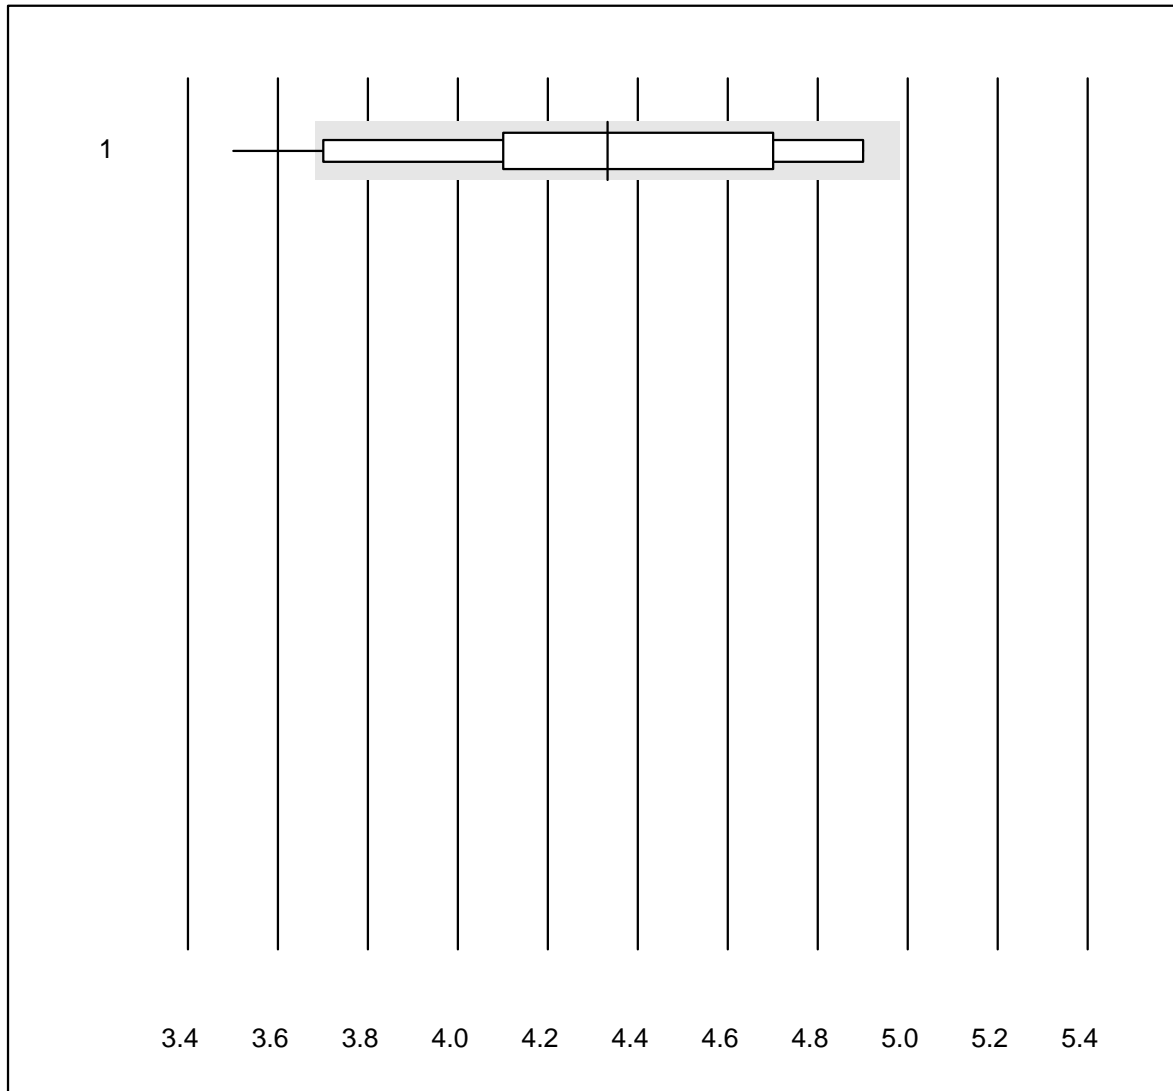


Tolérance QUALAB : 15 %

INR HC ()


No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Hemochron j.	18	77.7	5.6	16.7	4.3	9.7	e*

Osmolalité

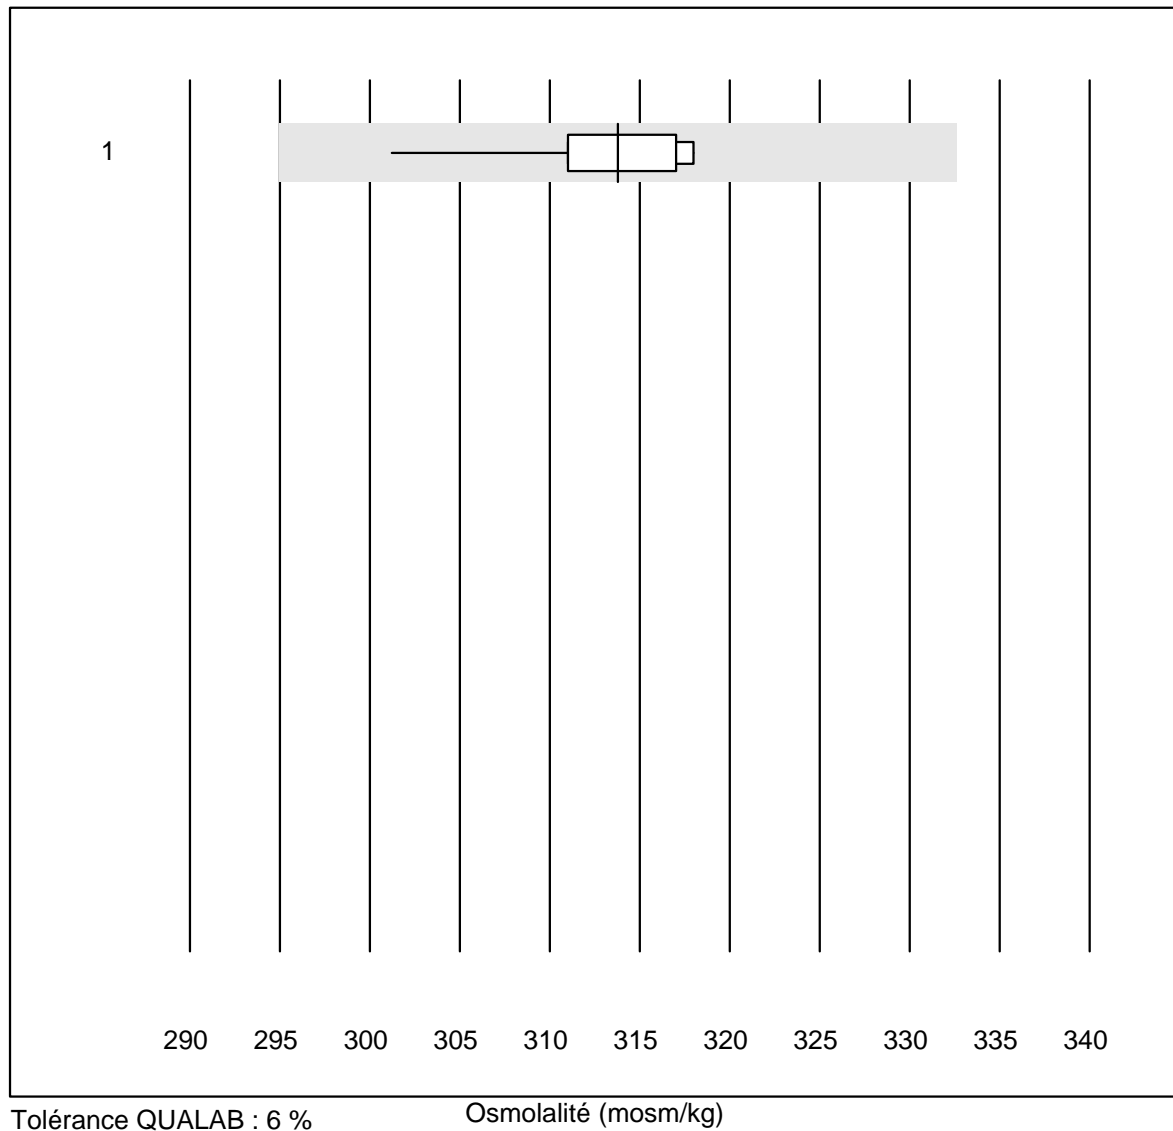

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cryoscopie	12	100.0	0.0	0.0	314	1.5	e

Kalium - K22

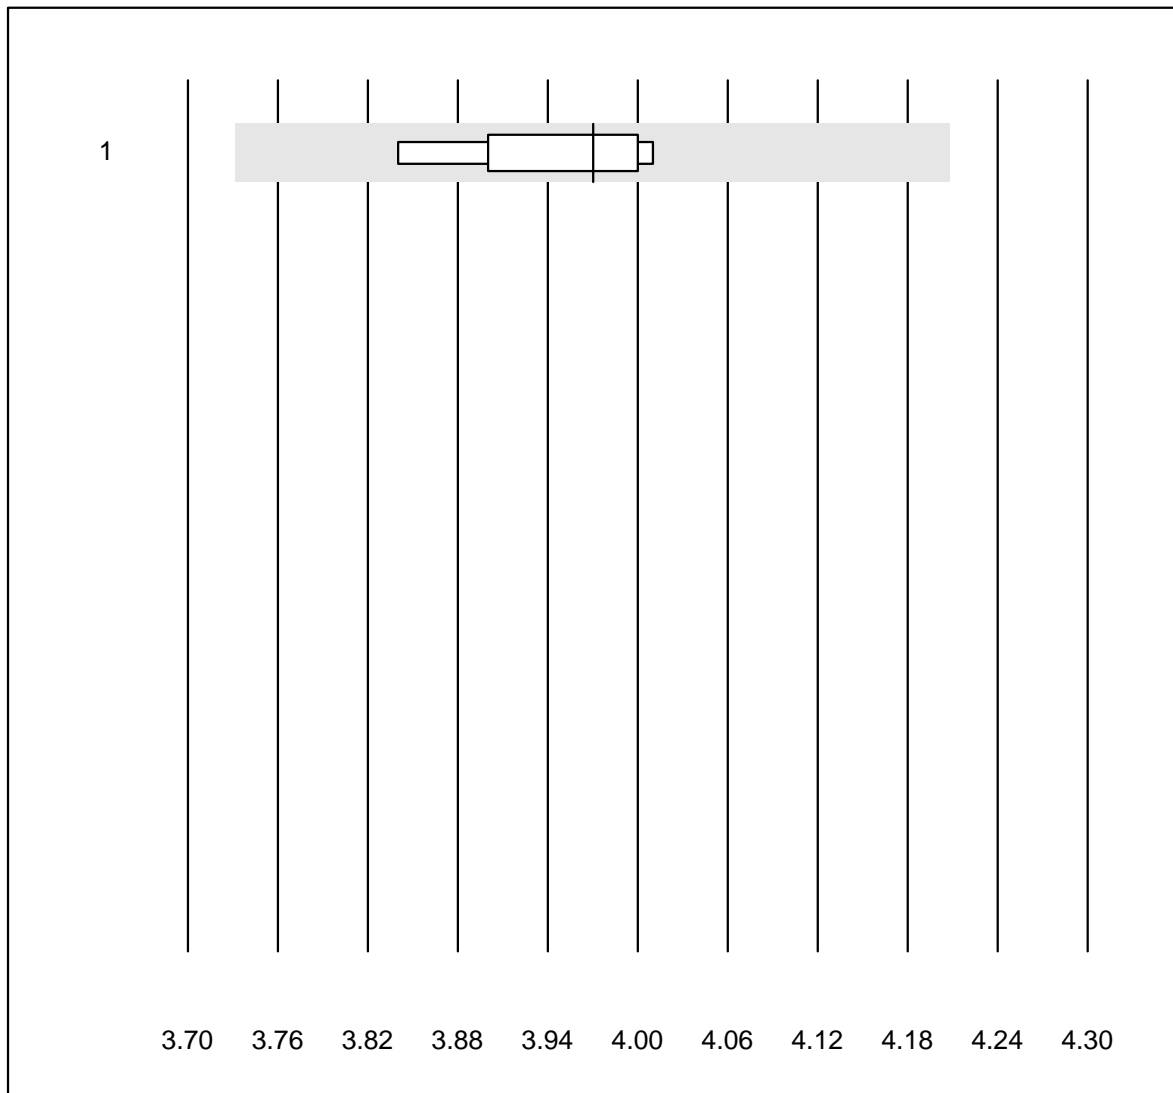


Tolérance QUALAB : 6 %

Kalium - K22 (mmol/l)

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ISE	8	100.0	0.0	0.0	4.0	1.6	e

Natrium - K22

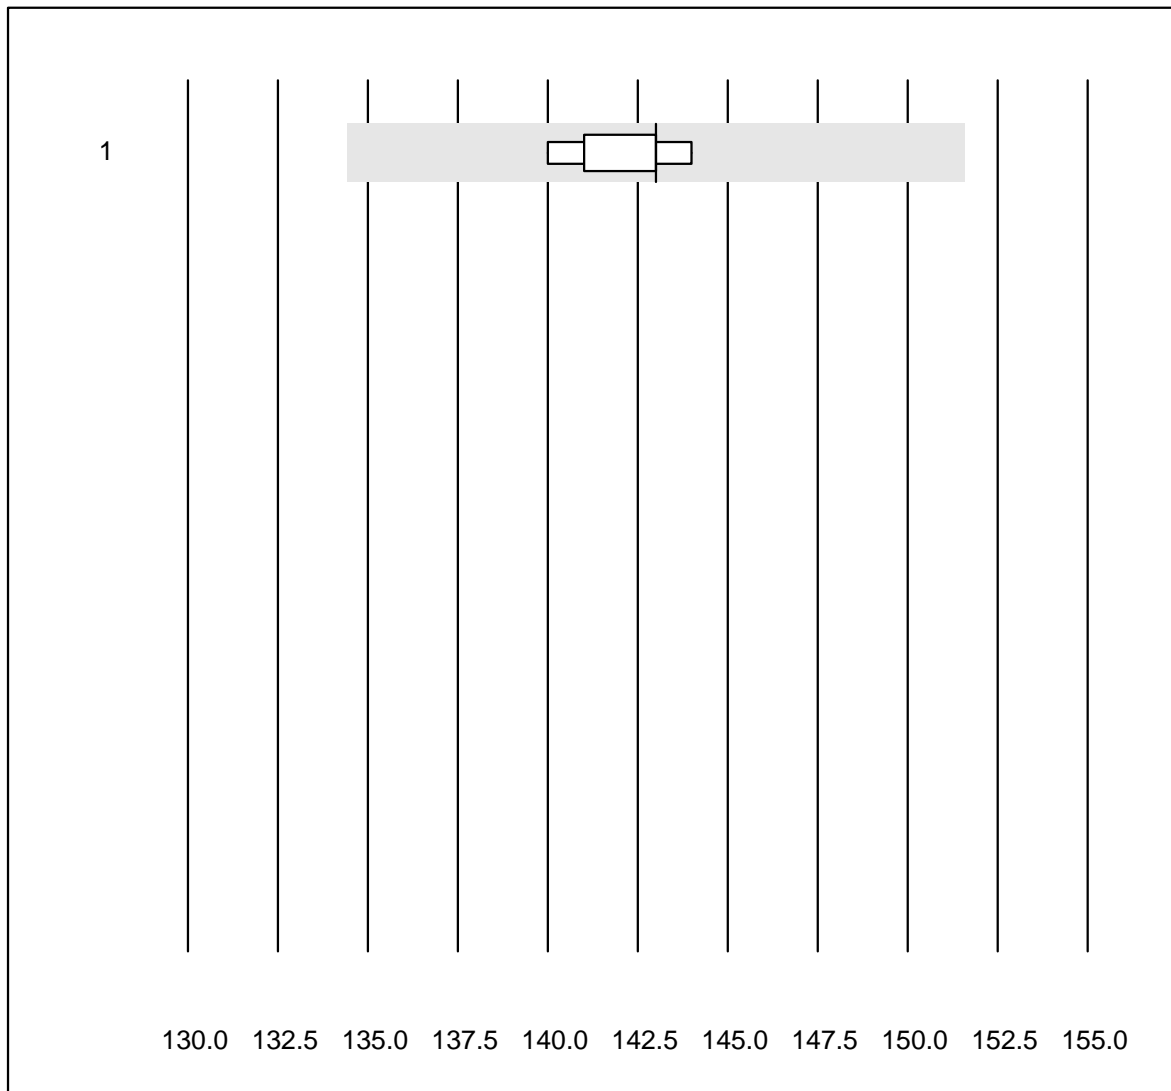


Tolérance QUALAB : 6 %

Natrium - K22 (mmol/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ISE	8	100.0	0.0	0.0	143	1.0	e

Glukose - K22

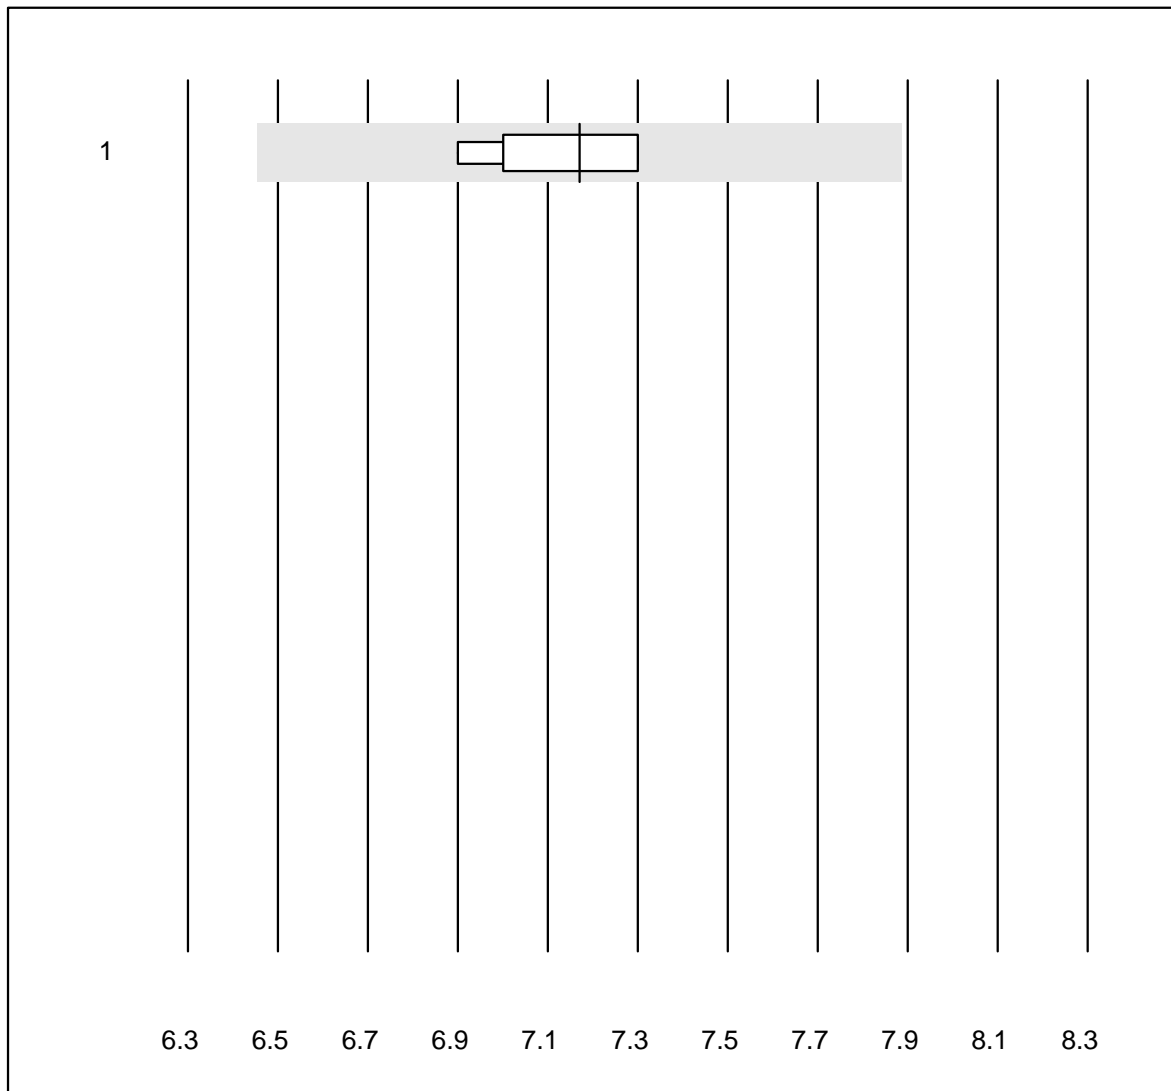


Tolérance QUALAB : 10 %

Glukose - K22 (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	8	100.0	0.0	0.0	7.2	2.1	e

Harnstoff - K22

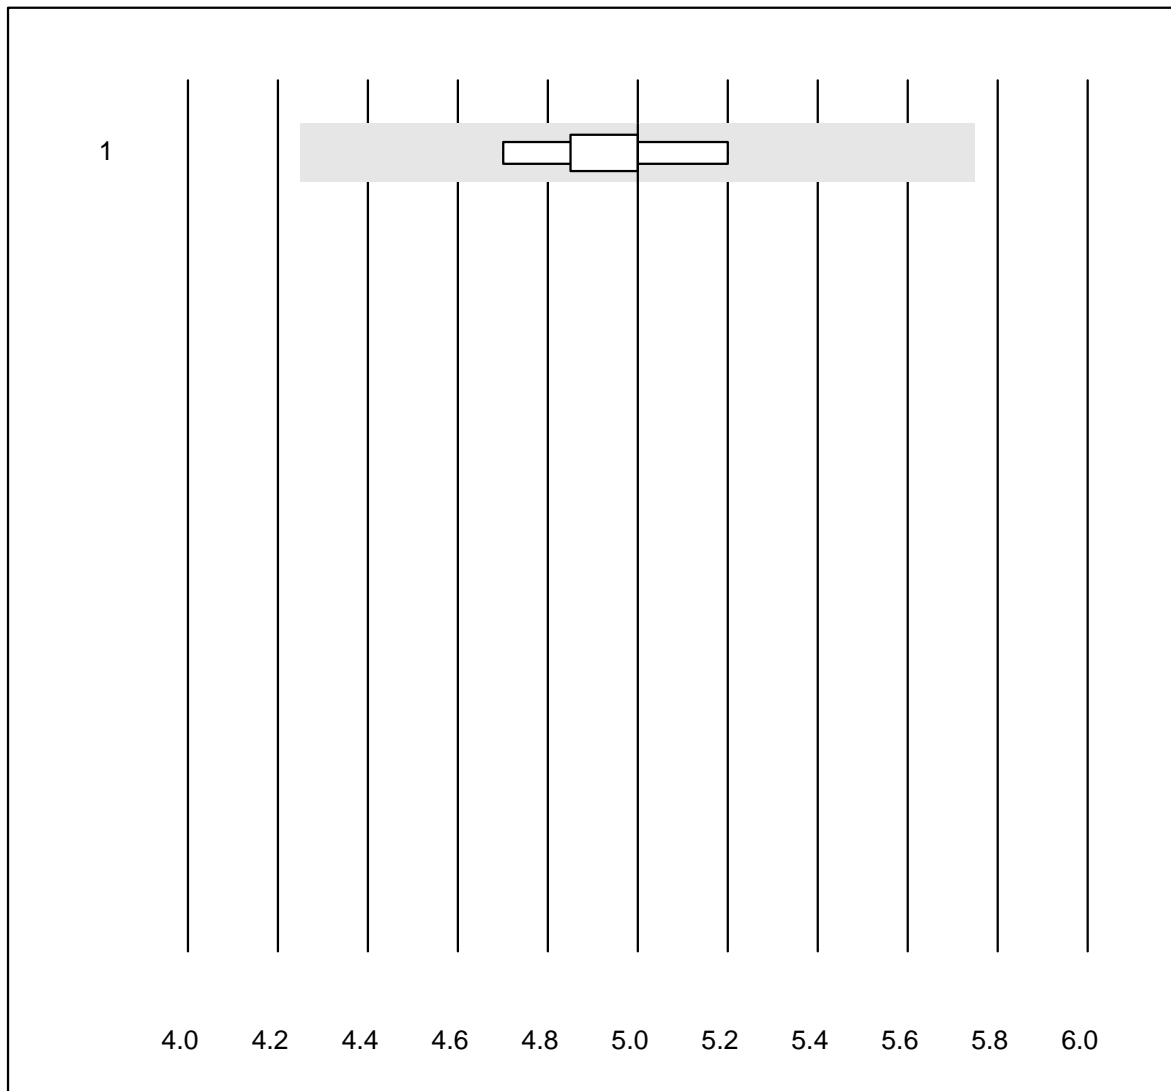


Tolérance QUALAB : 15 %

Harnstoff - K22 (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	8	87.5	0.0	12.5	5.0	3.1	e

Osmotische Lücke

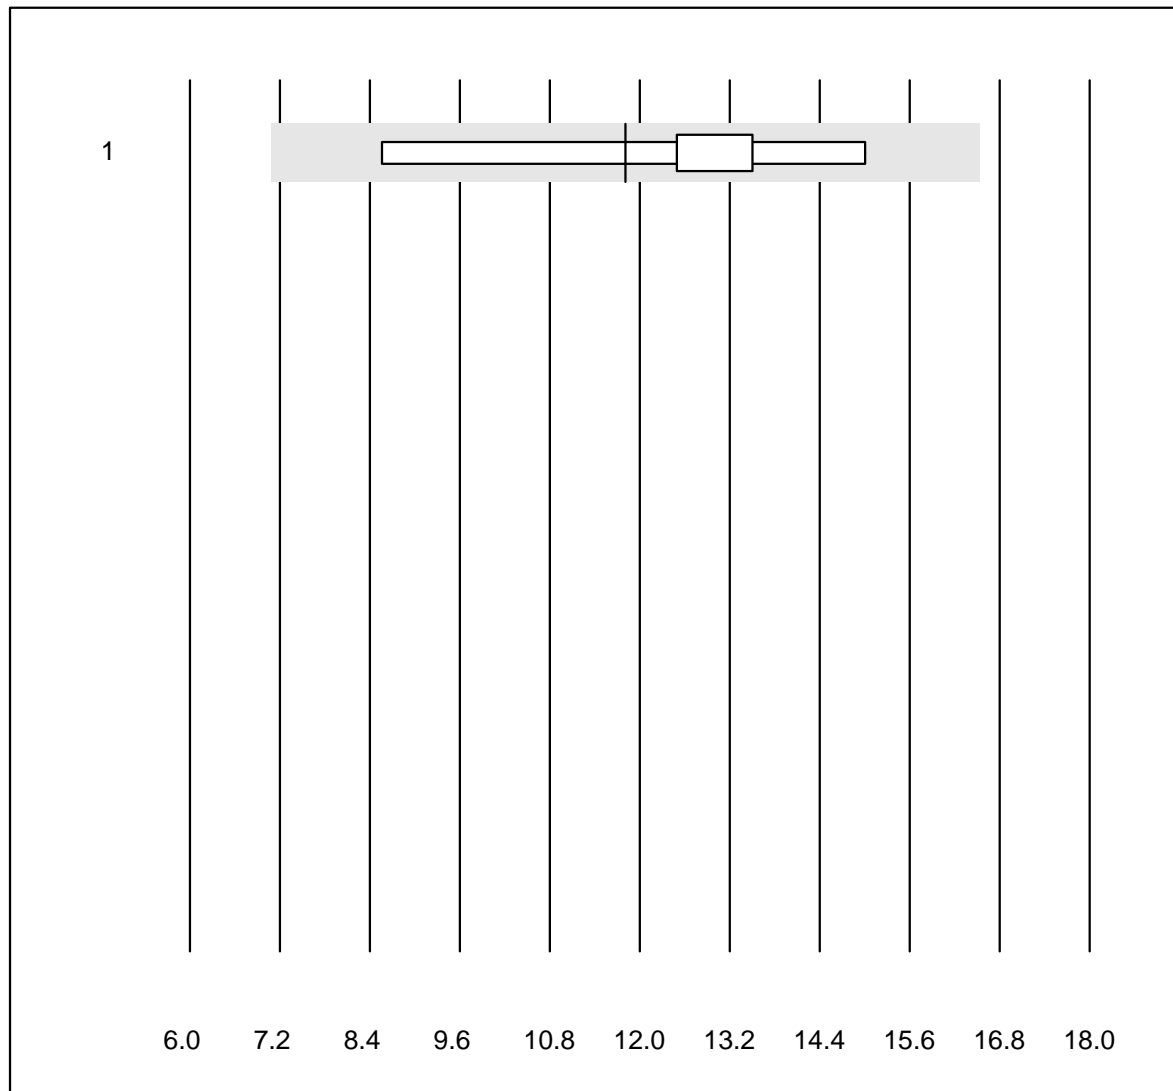


Tolérance QUALAB : 20 %

Osmotische Lücke (mmol/l)


No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Formel 1 (2Na+K+Glu+	7	71.4	0.0	28.6	11.8	19.2	a

Procalcitonine

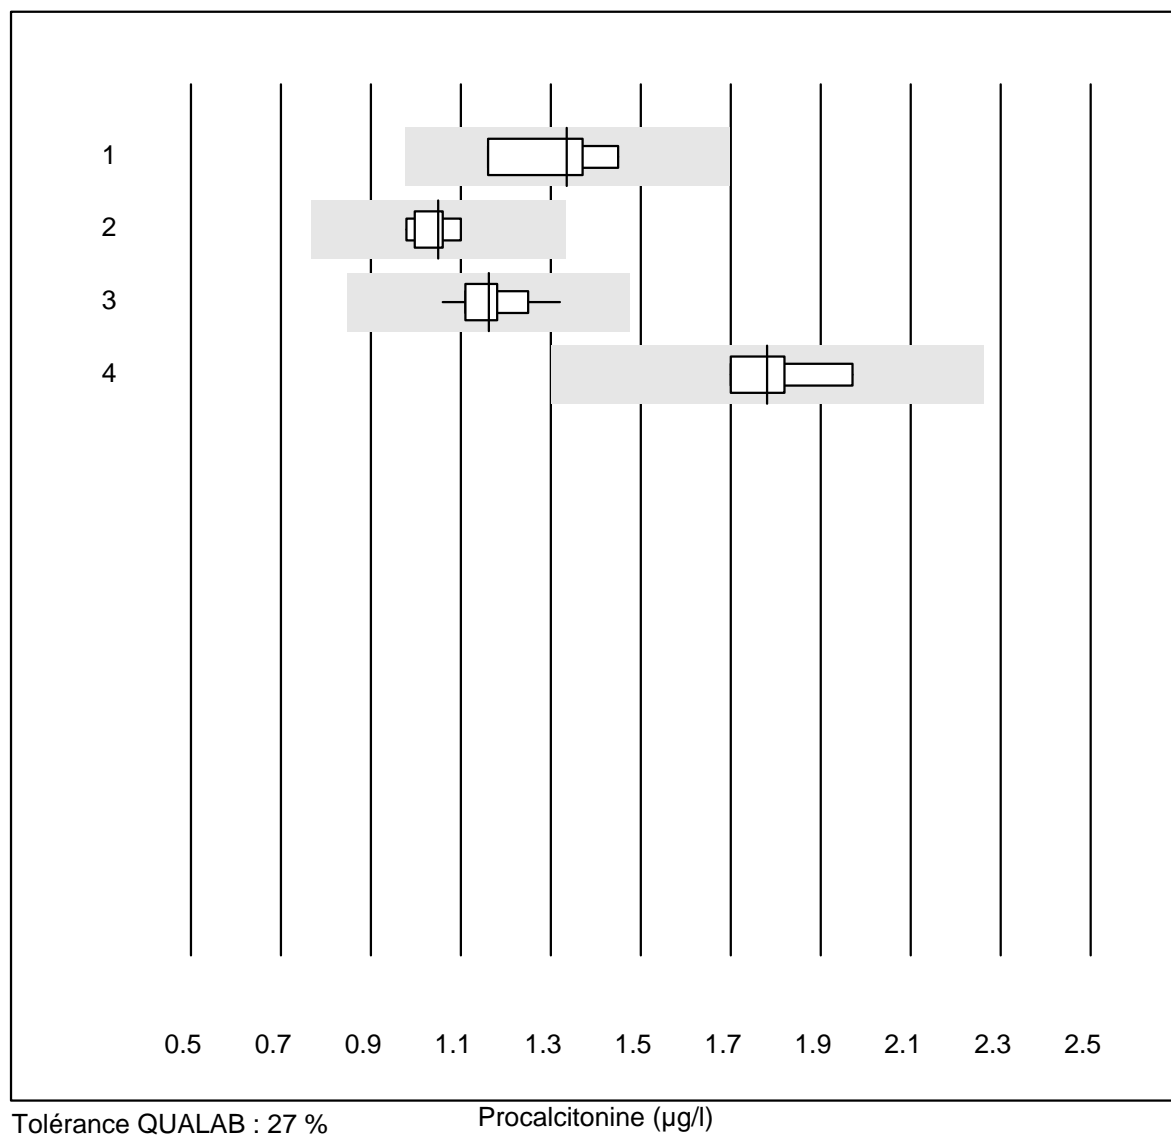


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	1.34	9.3	e*
2 Cobas	7	100.0	0.0	0.0	1.05	4.0	e
3 Mini Vidas	12	100.0	0.0	0.0	1.16	6.1	e
4 Liason	5	100.0	0.0	0.0	1.78	6.2	e

Parathormone

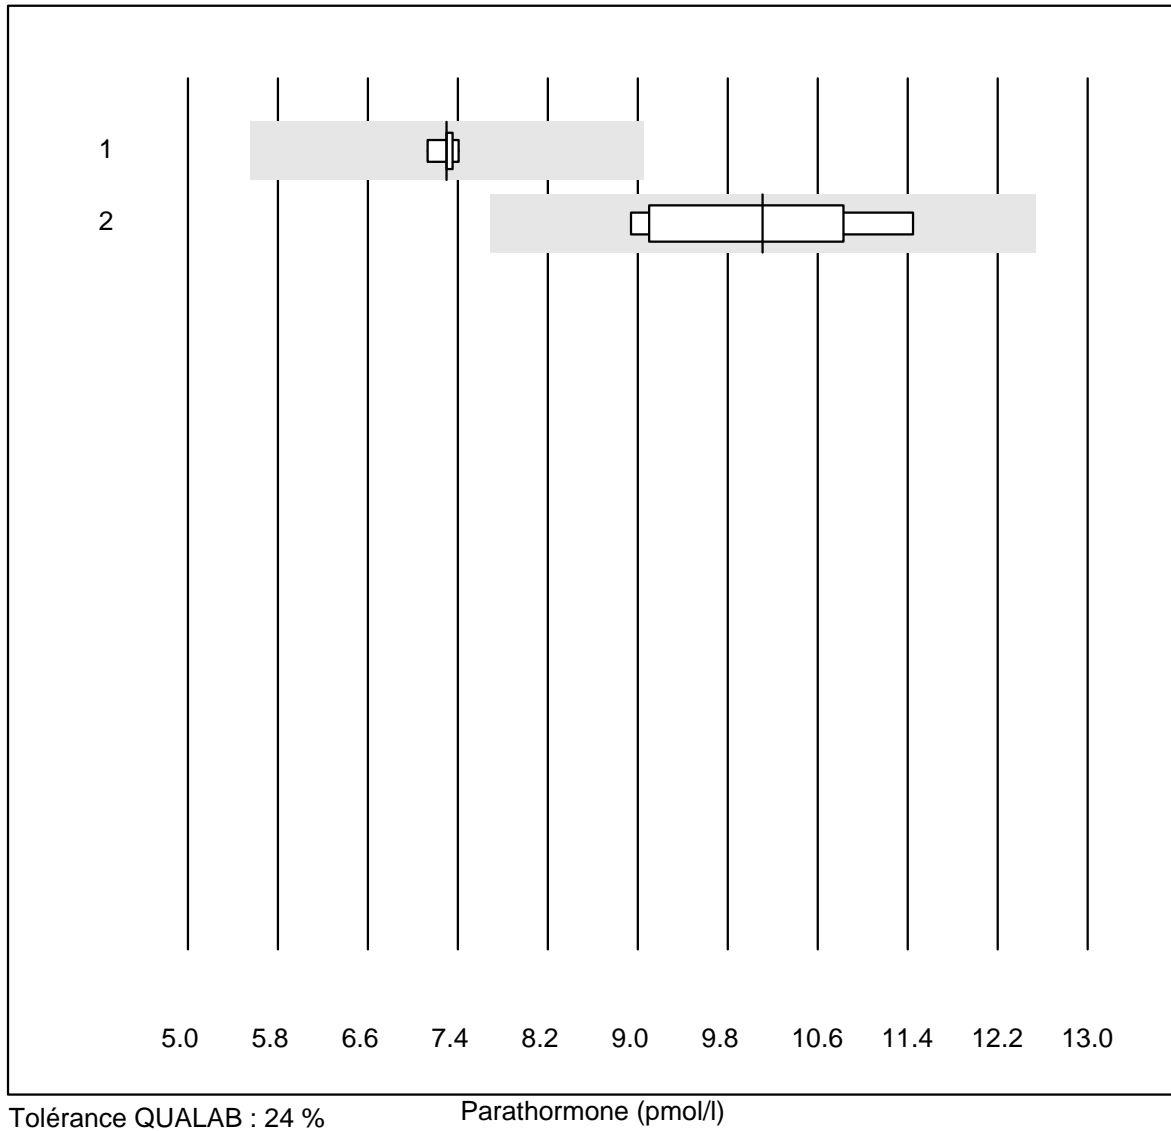

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas PTH STAT	5	100.0	0.0	0.0	7.3	1.4	e
2	toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	10.1	10.7	e*

25-OH Vitamin D

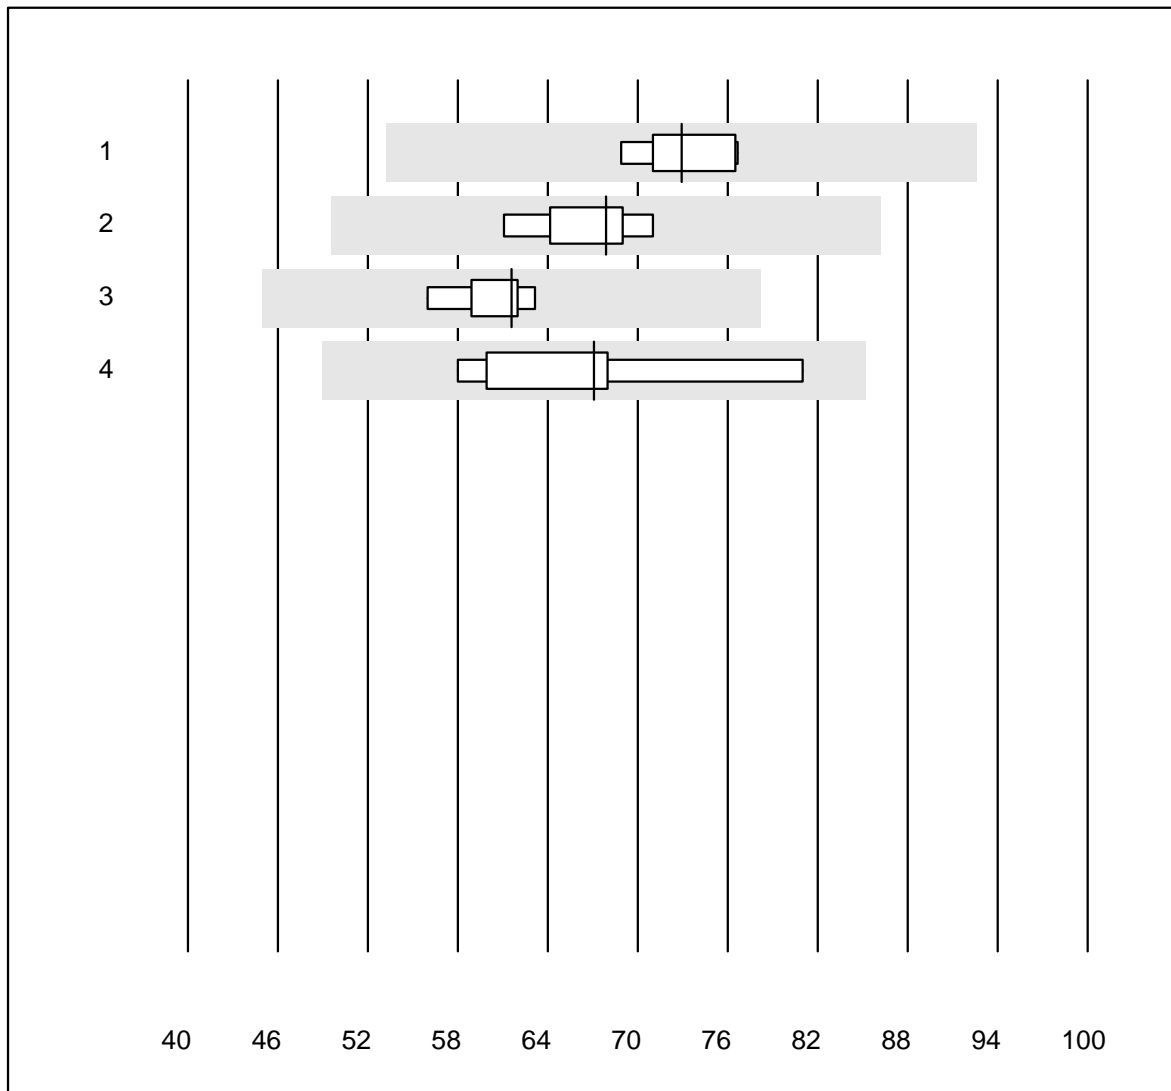


Tolérance QUALAB : 27 %

25-OH Vitamin D (nmol/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	72.9	4.6	e
2 Vidas	5	100.0	0.0	0.0	67.9	6.0	e
3 Architect	7	100.0	0.0	0.0	61.6	4.0	e
4 Qualigen	5	100.0	0.0	0.0	67.1	13.6	e*

Digoxin

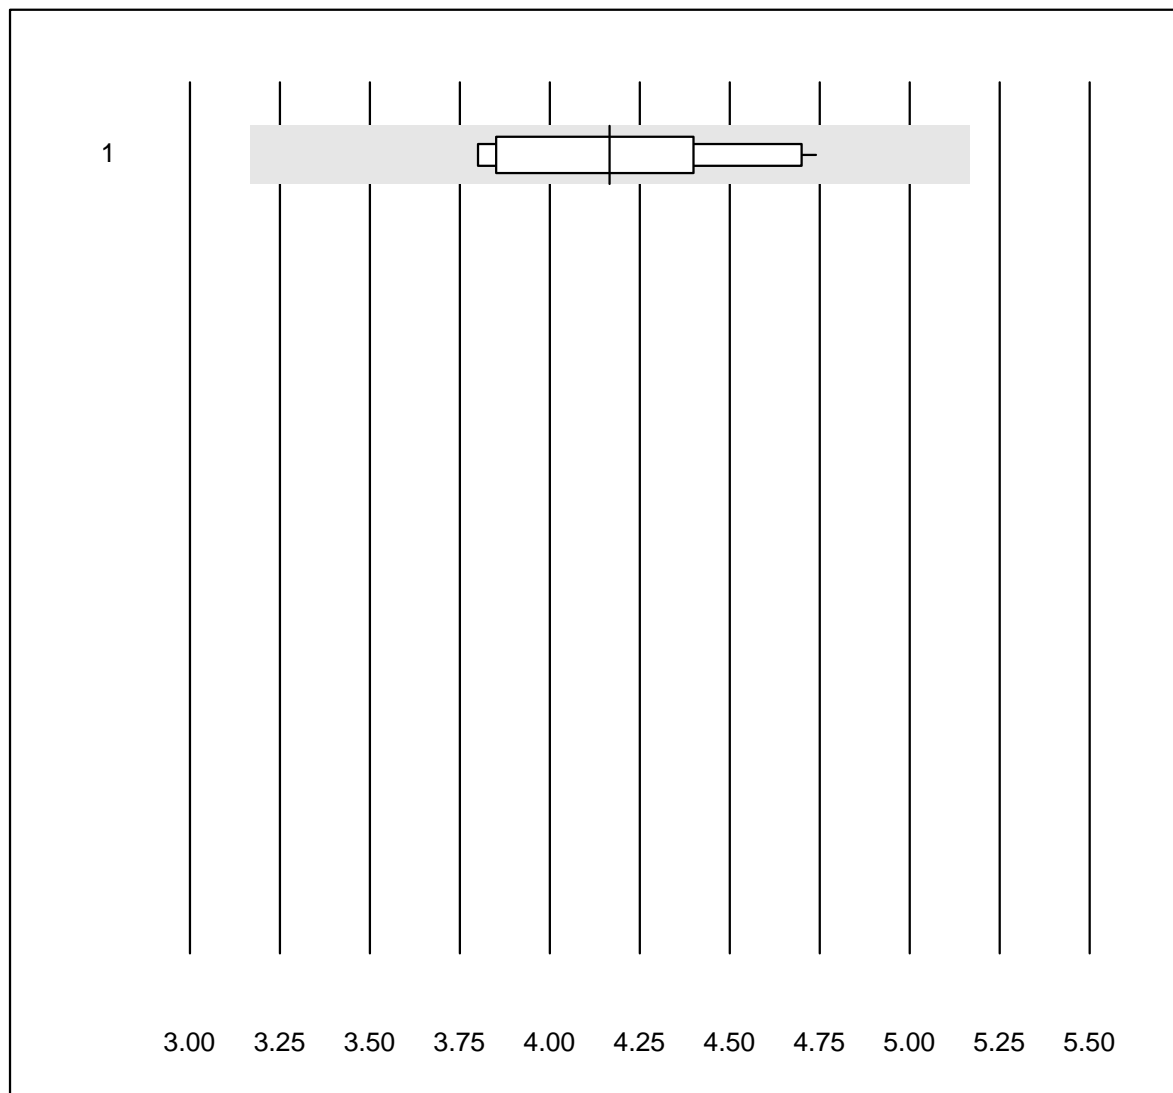


Tolérance QUALAB : 24 %

Digoxin (nmol/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Autres méthodes	10	100.0	0.0	0.0	4.17	8.2	e

Valproat

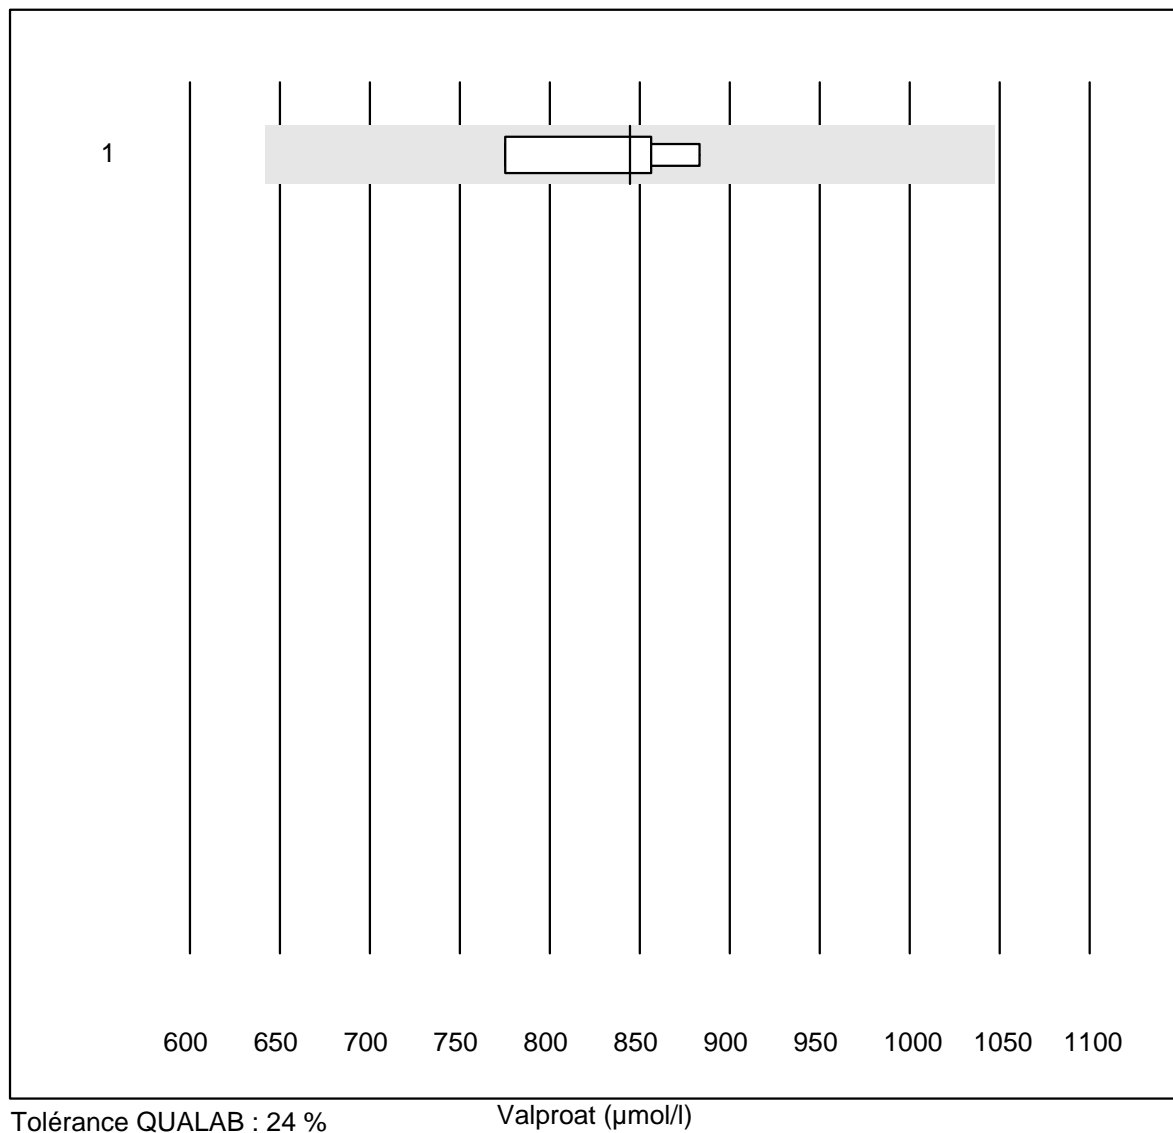

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	844.7	5.5	e

Cystatin C

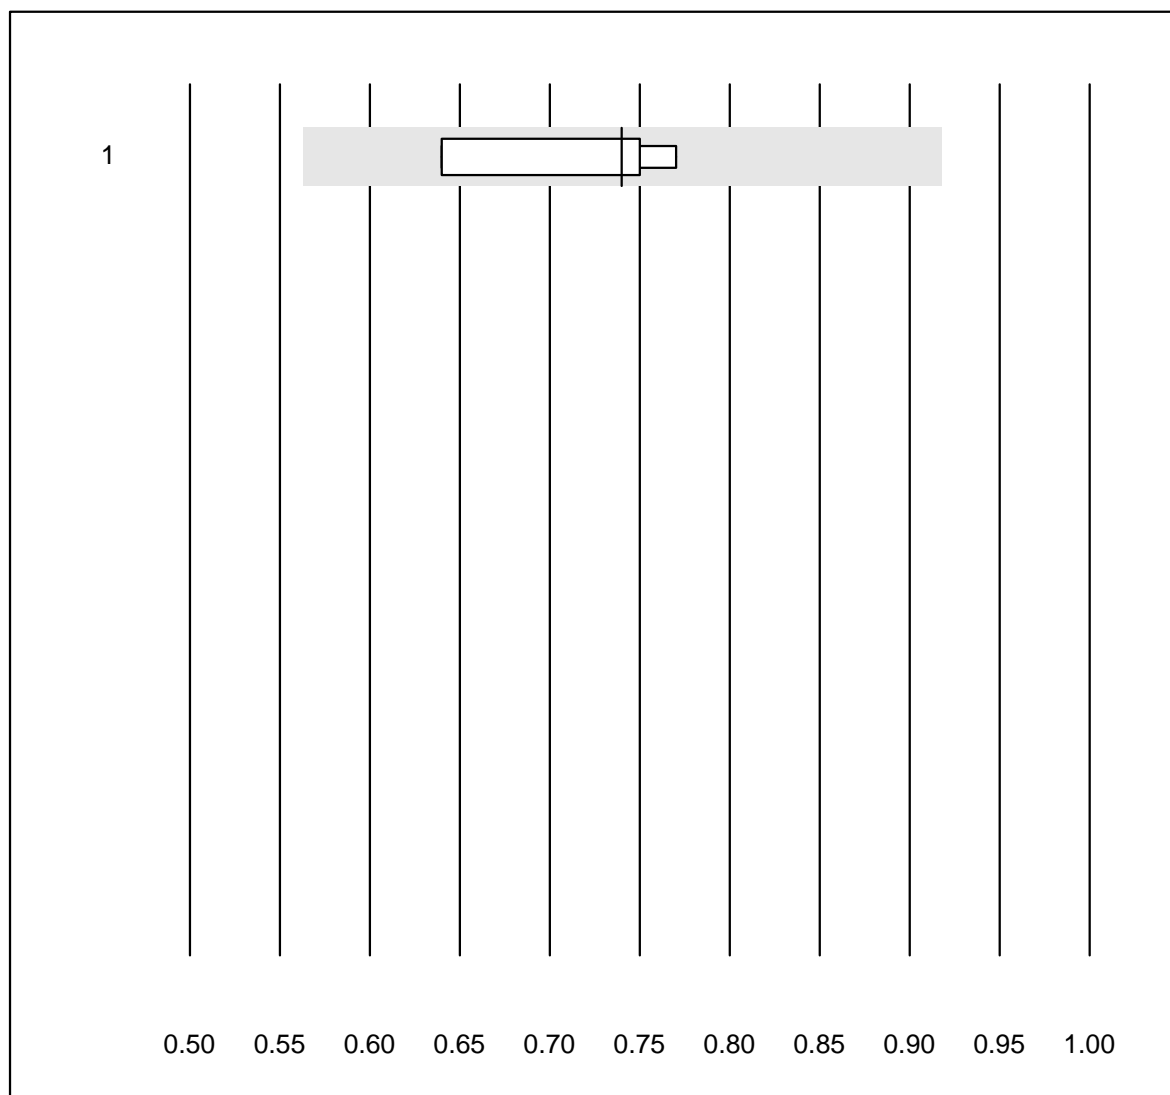


Tolérance QUALAB : 24 %

Cystatin C (mg/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	0.7	7.9	e*

Hémoglobine BG

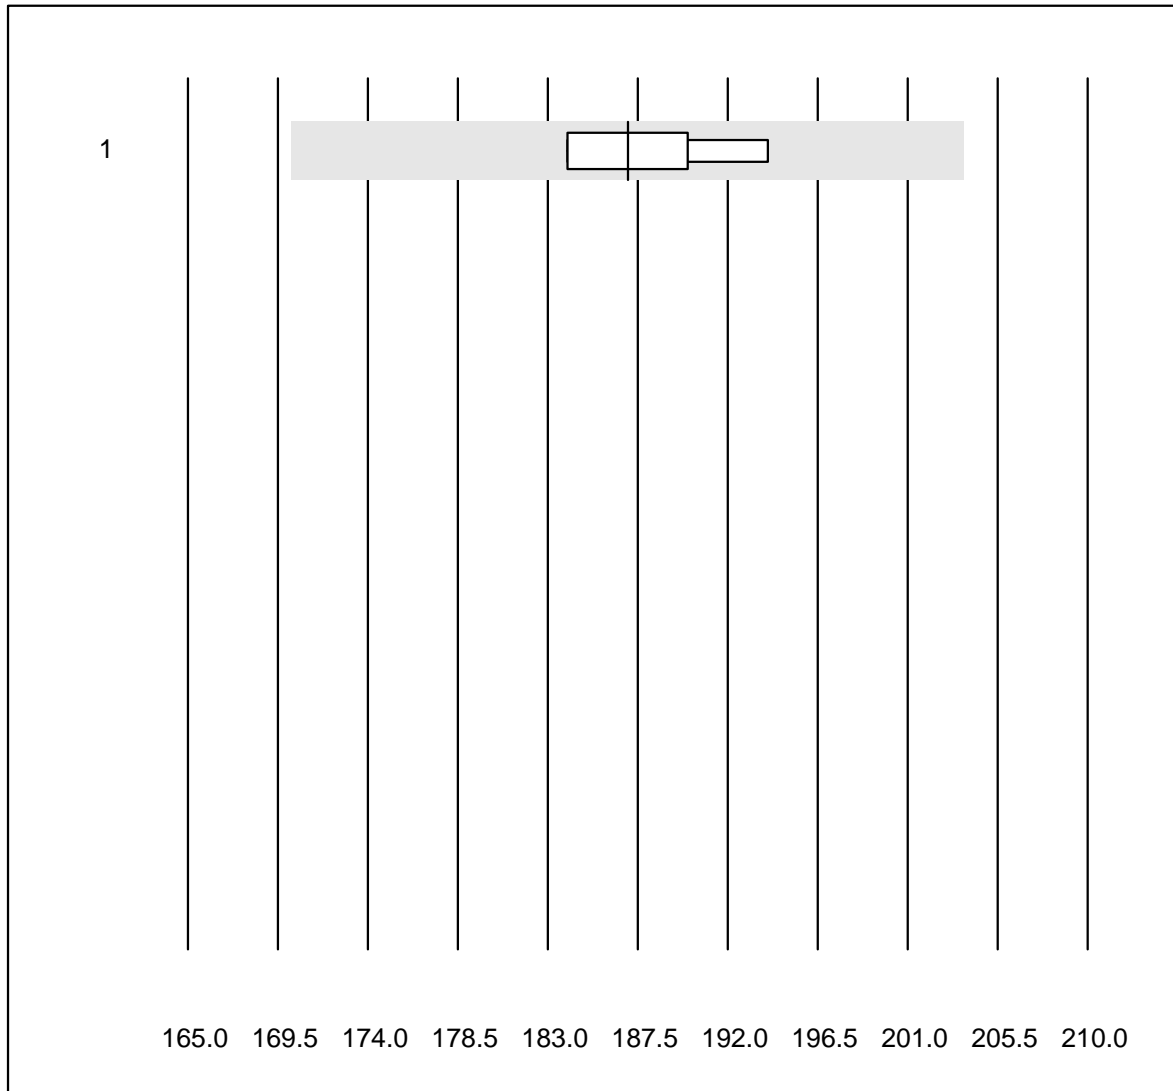


Tolérance QUALAB : 9 %

Hémoglobine BG (g/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 iStat	4	100.0	0.0	0.0	187.0	2.6	e*

Hématocrite

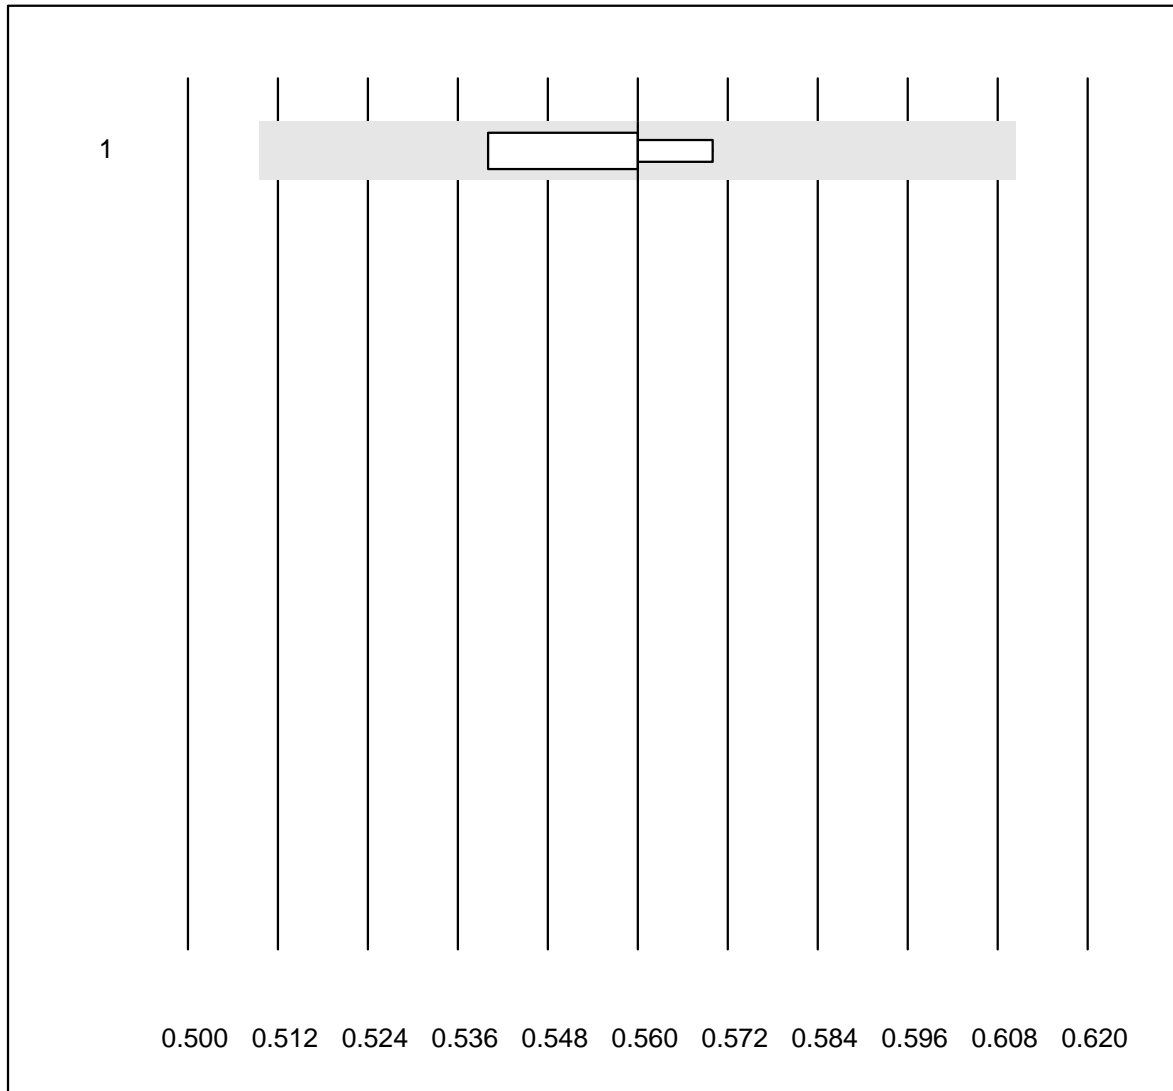


Tolérance QUALAB : 9 %

Hématocrite (l/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 iStat	5	100.0	0.0	0.0	0.56	2.4	e*

Troponin Triage

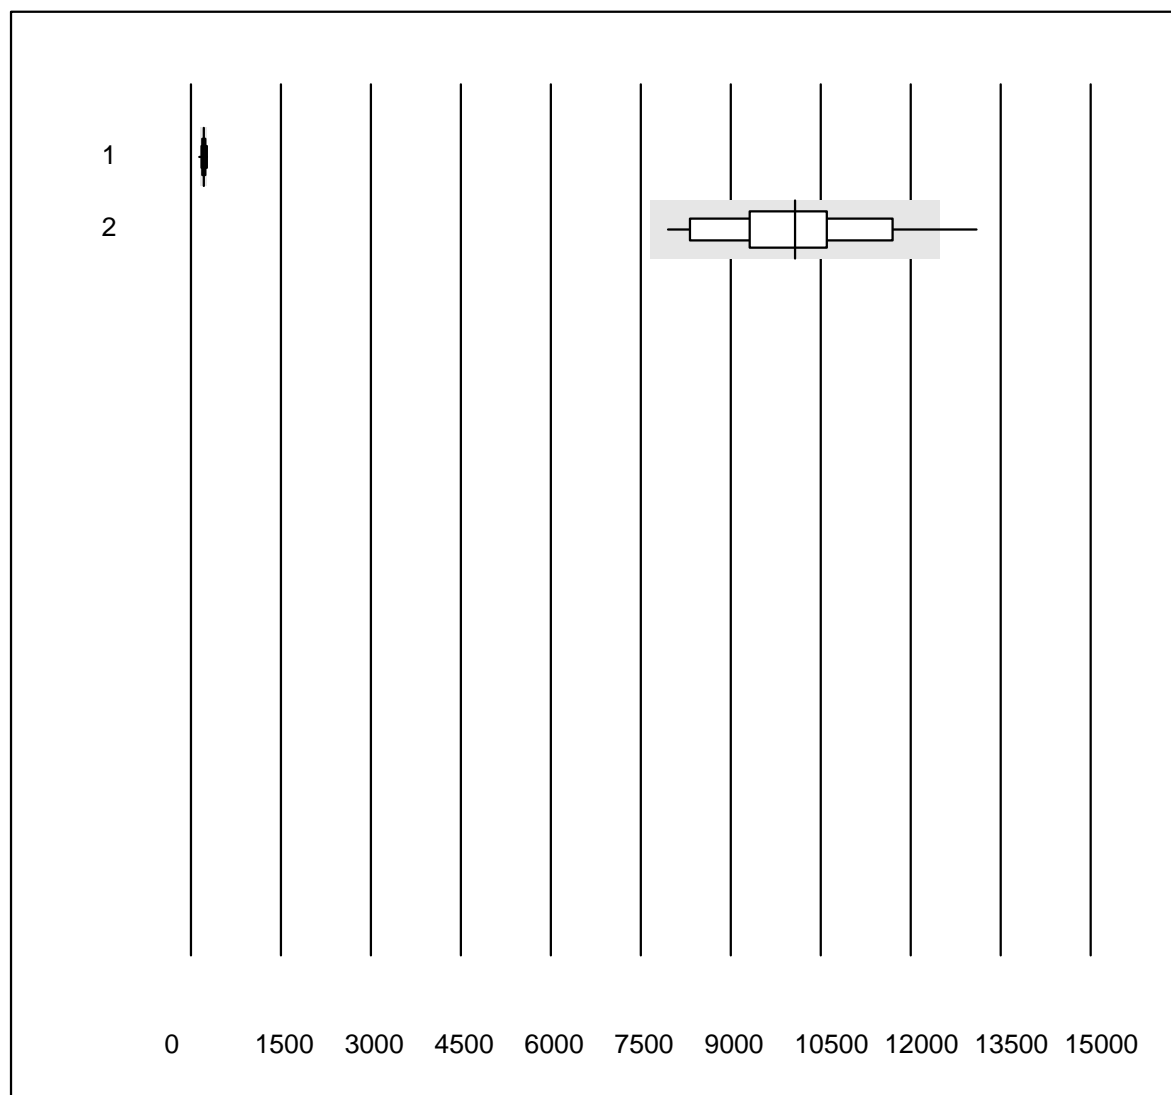


Tolérance QUALAB : 24 %

Troponin Triage (ng/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Triage Next Gen	35	60.0	5.7	34.3	211.74	16.7	e
2	Triage SOB/Cardiac	18	88.8	5.6	5.6	10068.24	11.9	e

D-Dimere Triage

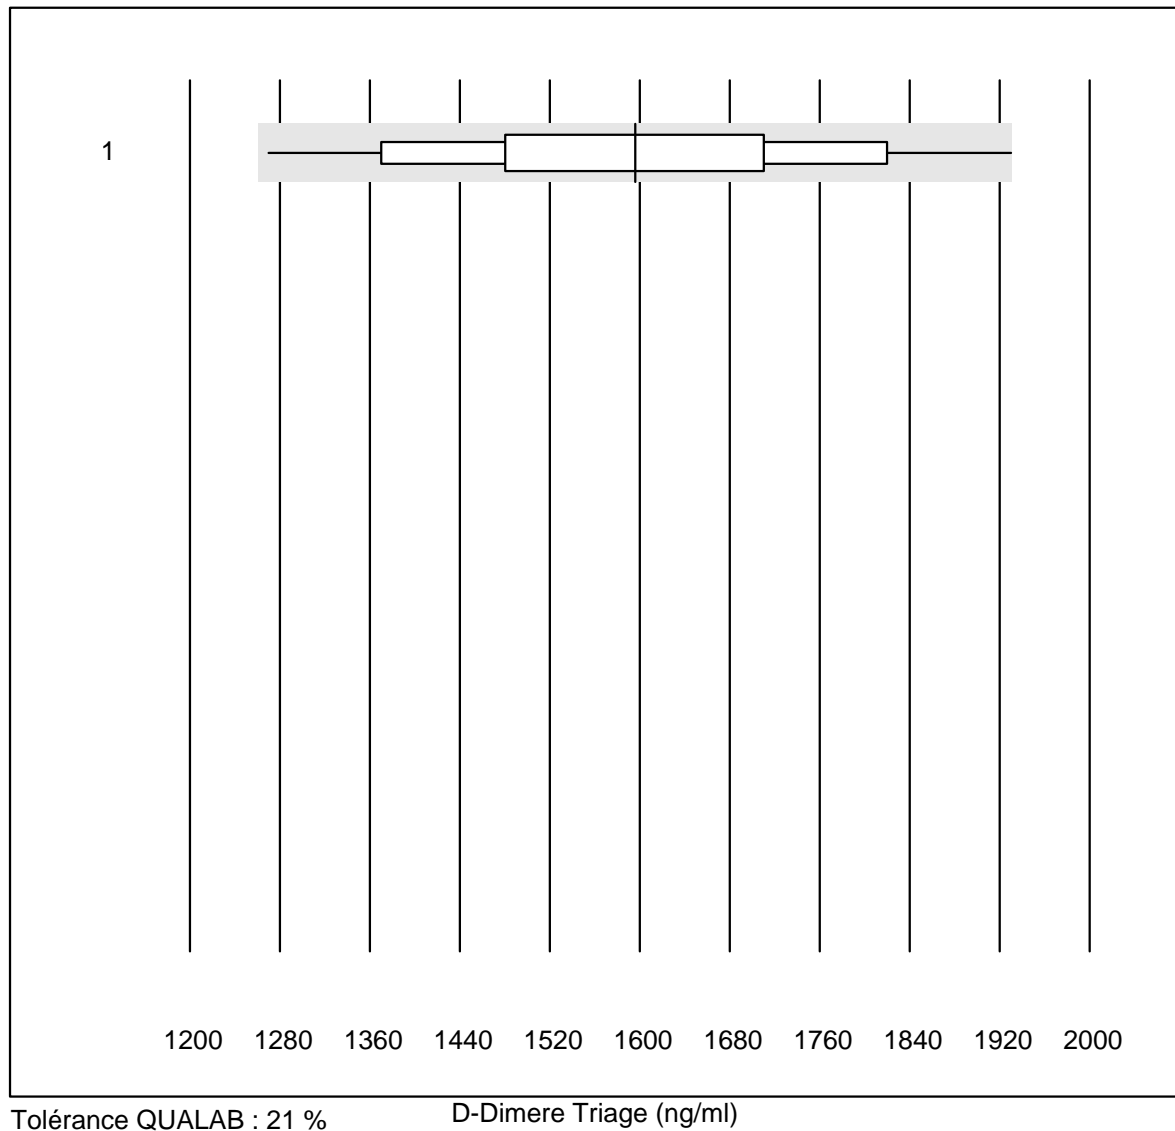

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Triage	49	93.9	0.0	6.1	1595.87	10.3	e

CK-MB Triage

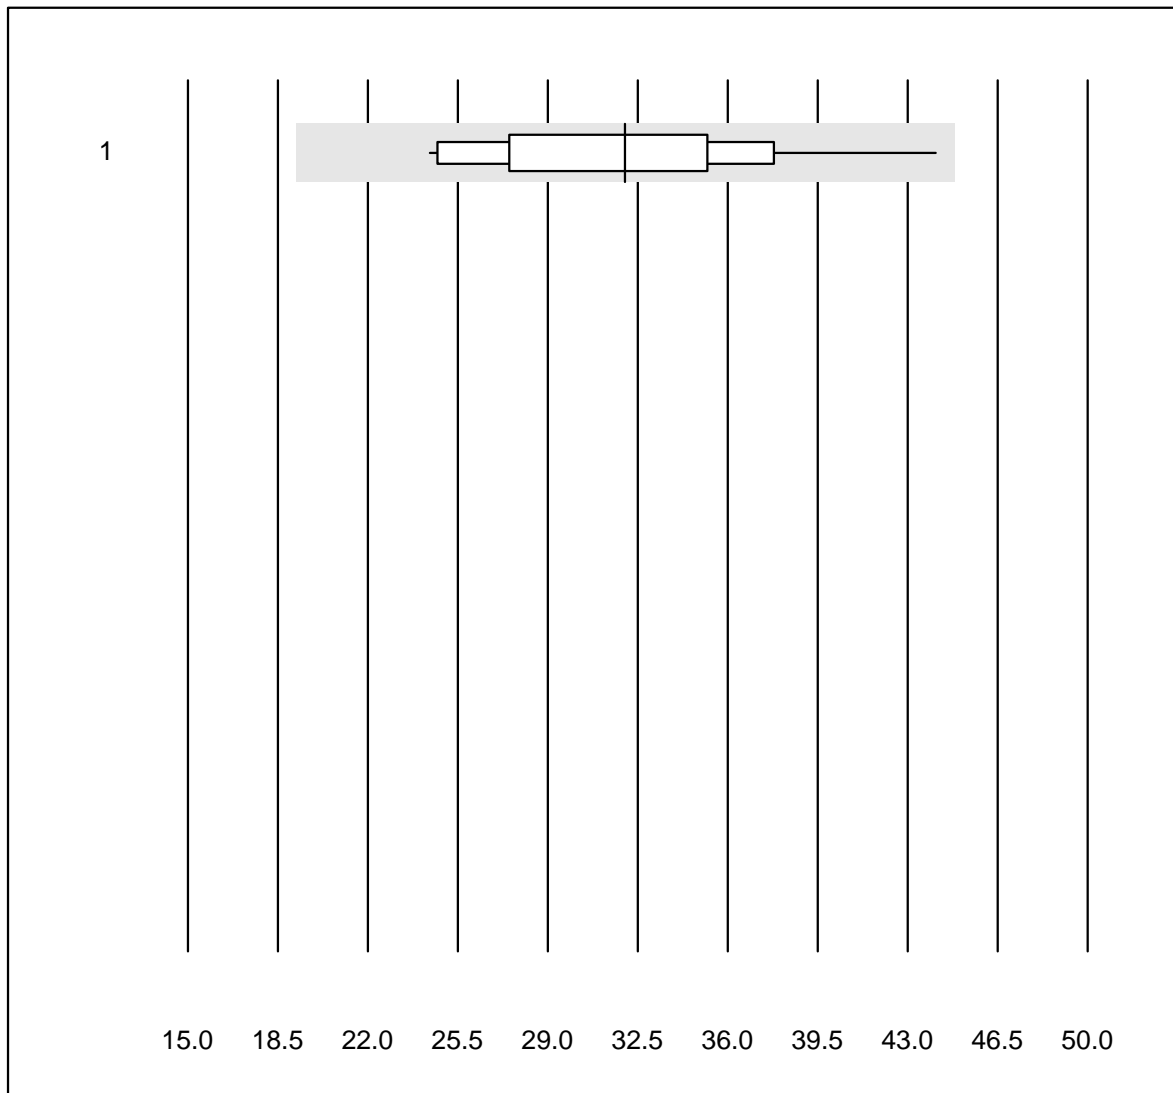


Tolérance QUALAB : 40 %

CK-MB Triage (µg/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Triage	16	93.7	0.0	6.3	32.0	16.4	e

Myoglobin Triage

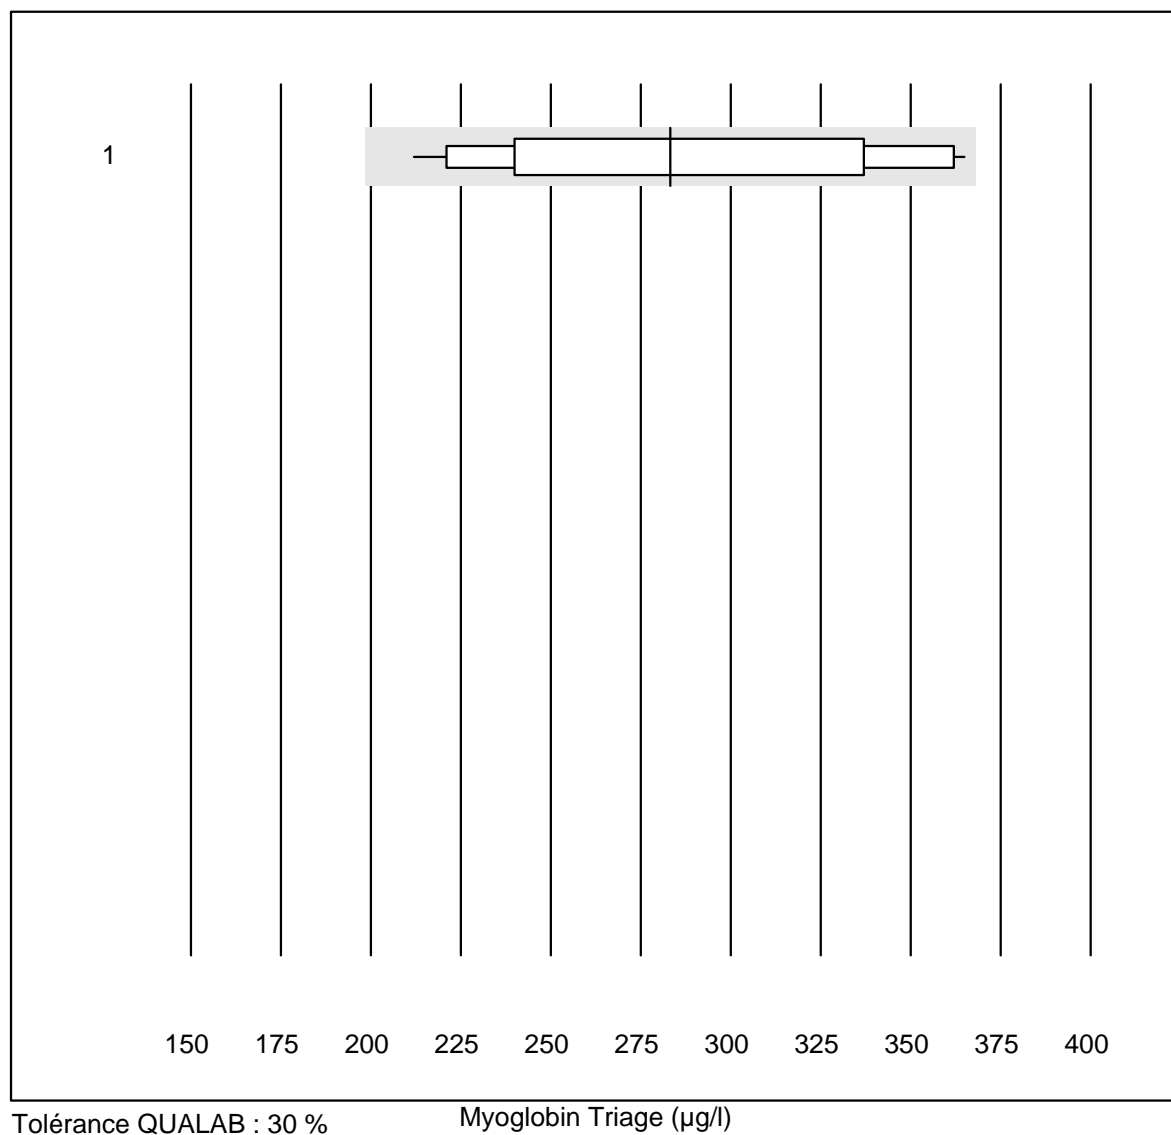


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Triage	15	100.0	0.0	0.0	283.2	18.6	e*

Alcool

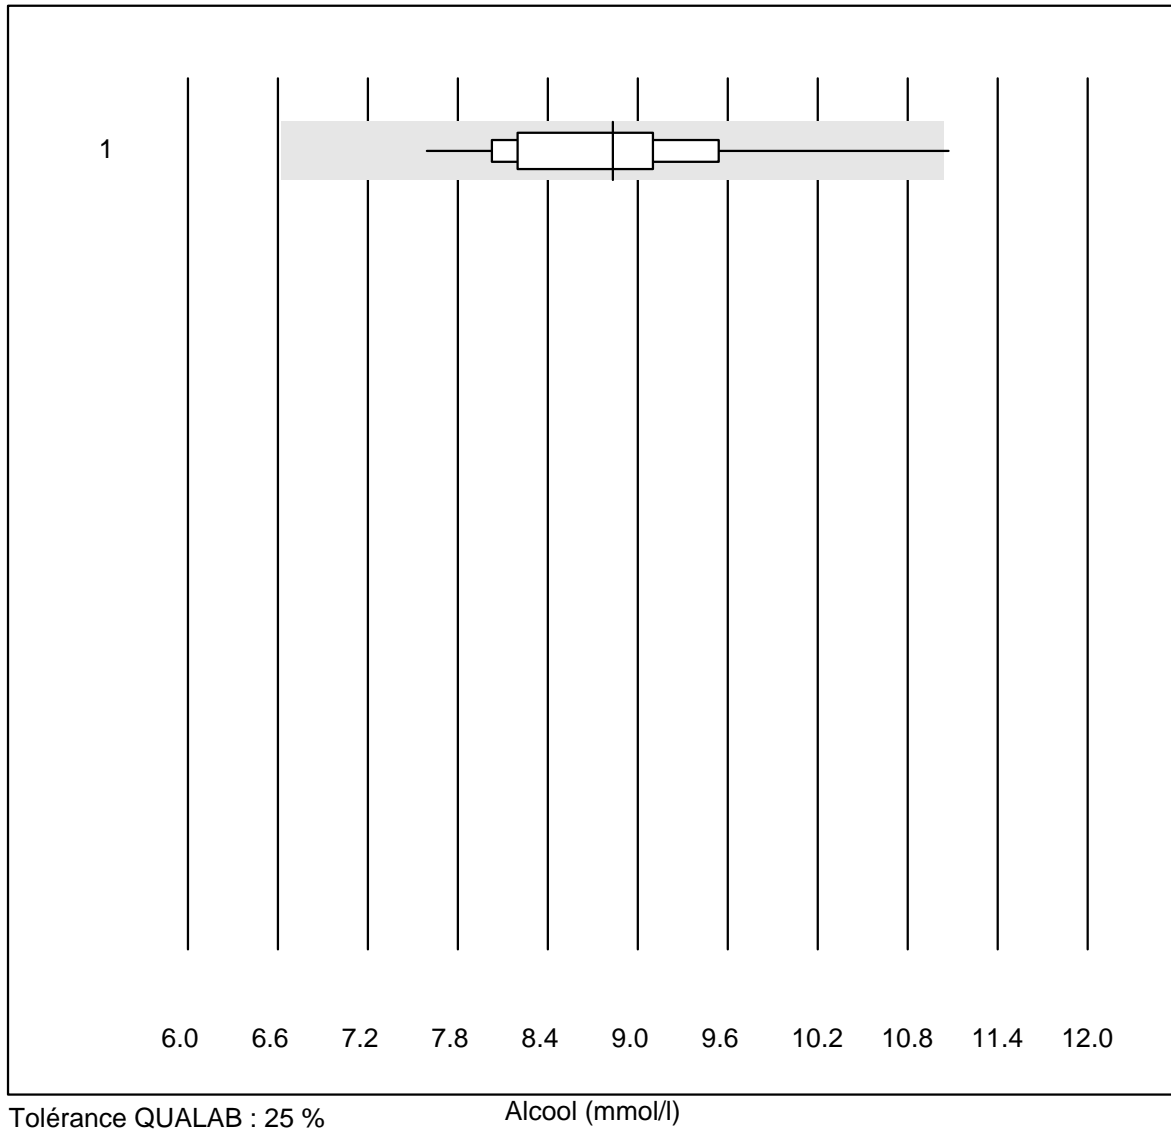


No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	14	92.9	7.1	0.0	8.8	9.7 e

Calprotectin

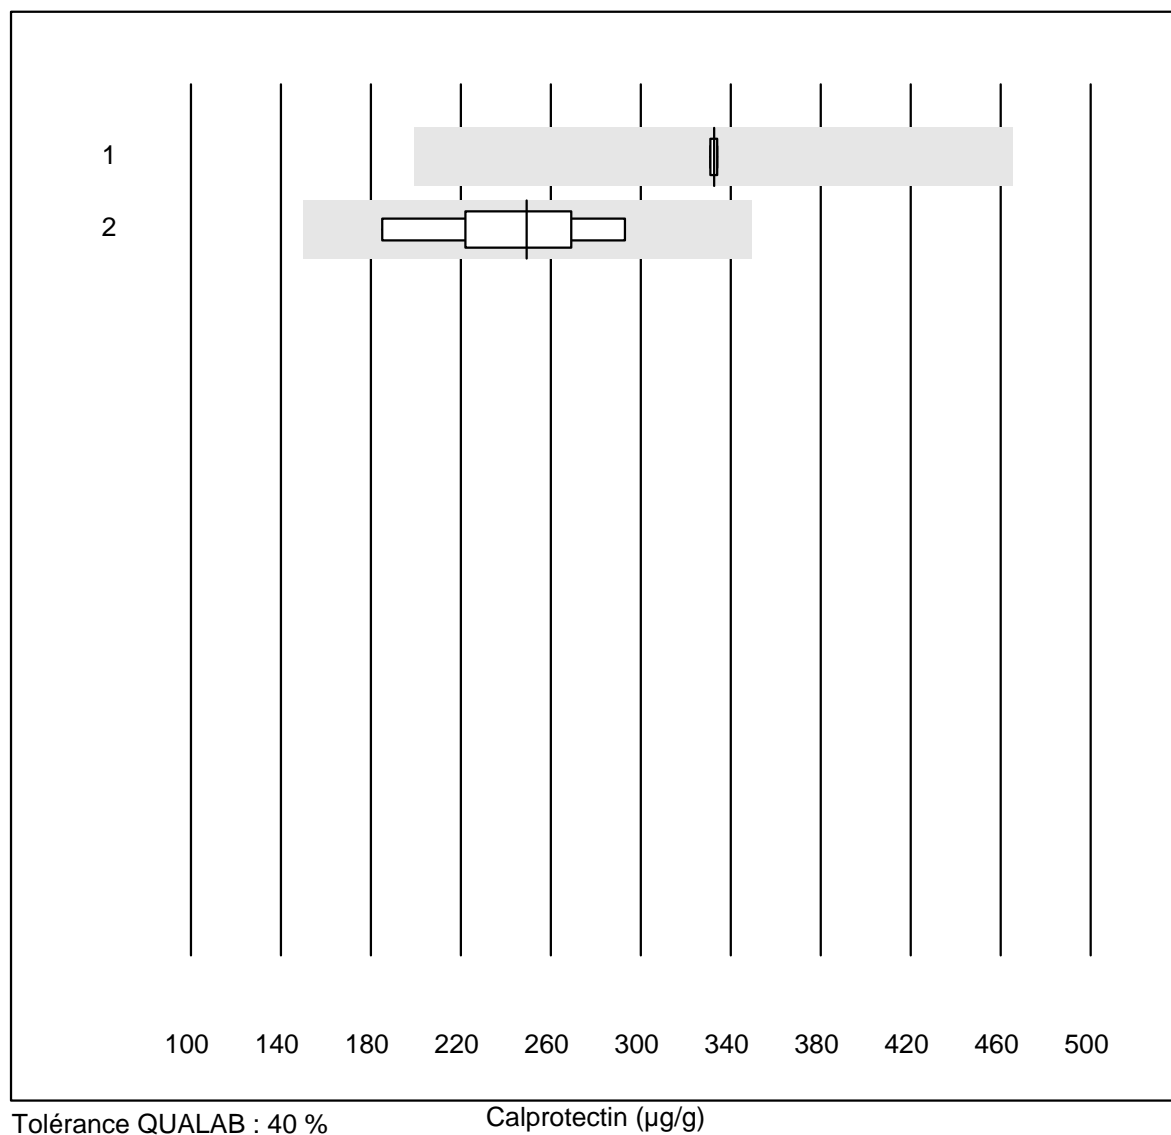

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Autres méthodes	4	50.0	0.0	50.0	333	0.6	e
2 Bühlmann	9	100.0	0.0	0.0	249	14.4	e*

Cholestérol Af/b101

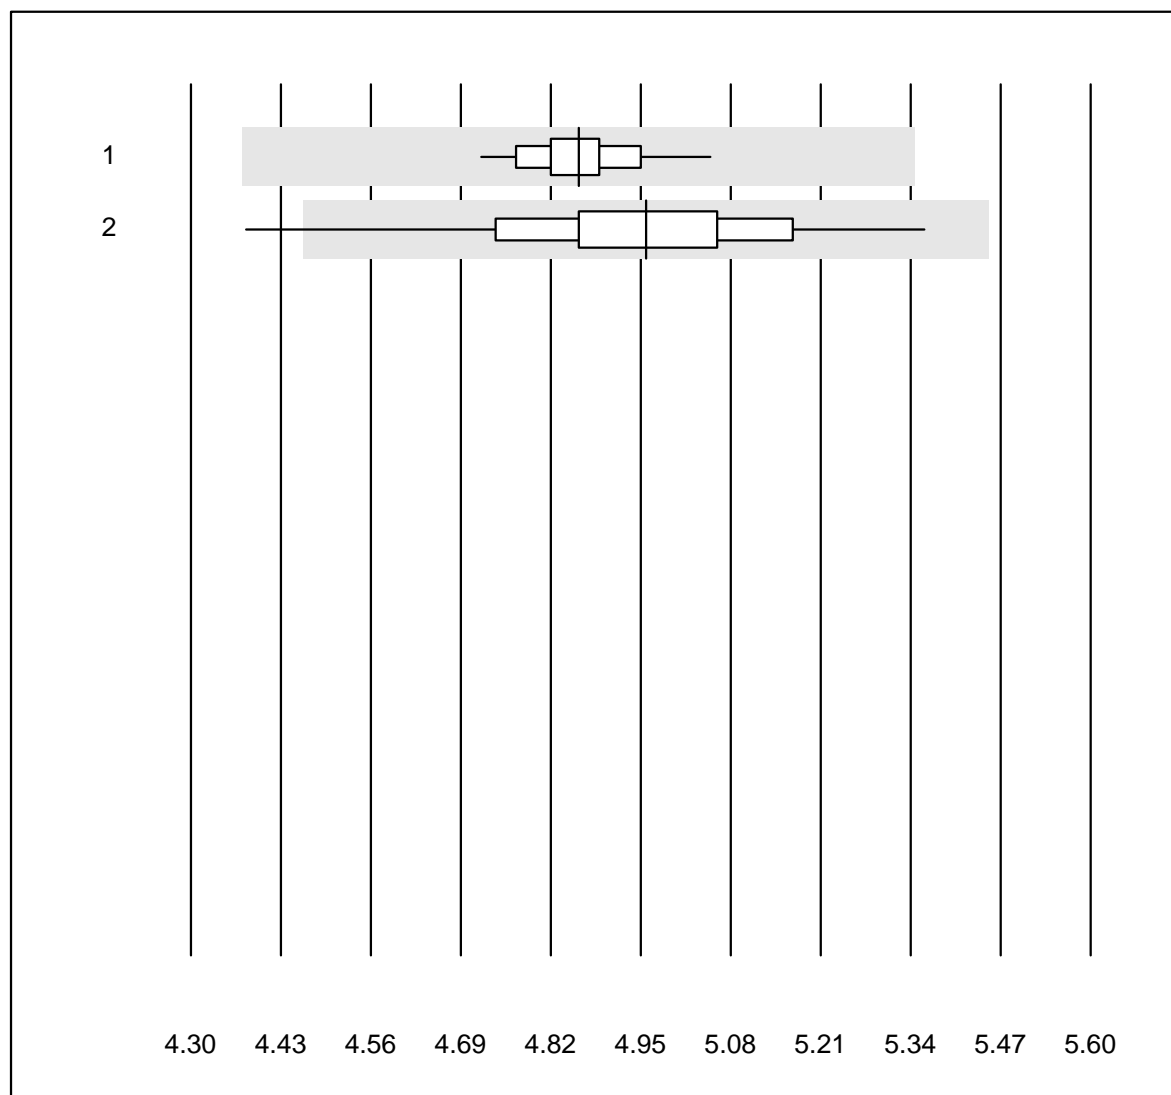


Tolérance QUALAB : 10 %

Cholestérol Af/b101 (mmol/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas b101	48	97.9	0.0	2.1	4.86	1.5	e
2 Afinion	293	99.0	1.0	0.0	4.96	3.3	e


Cholestérol HDL Af/b101

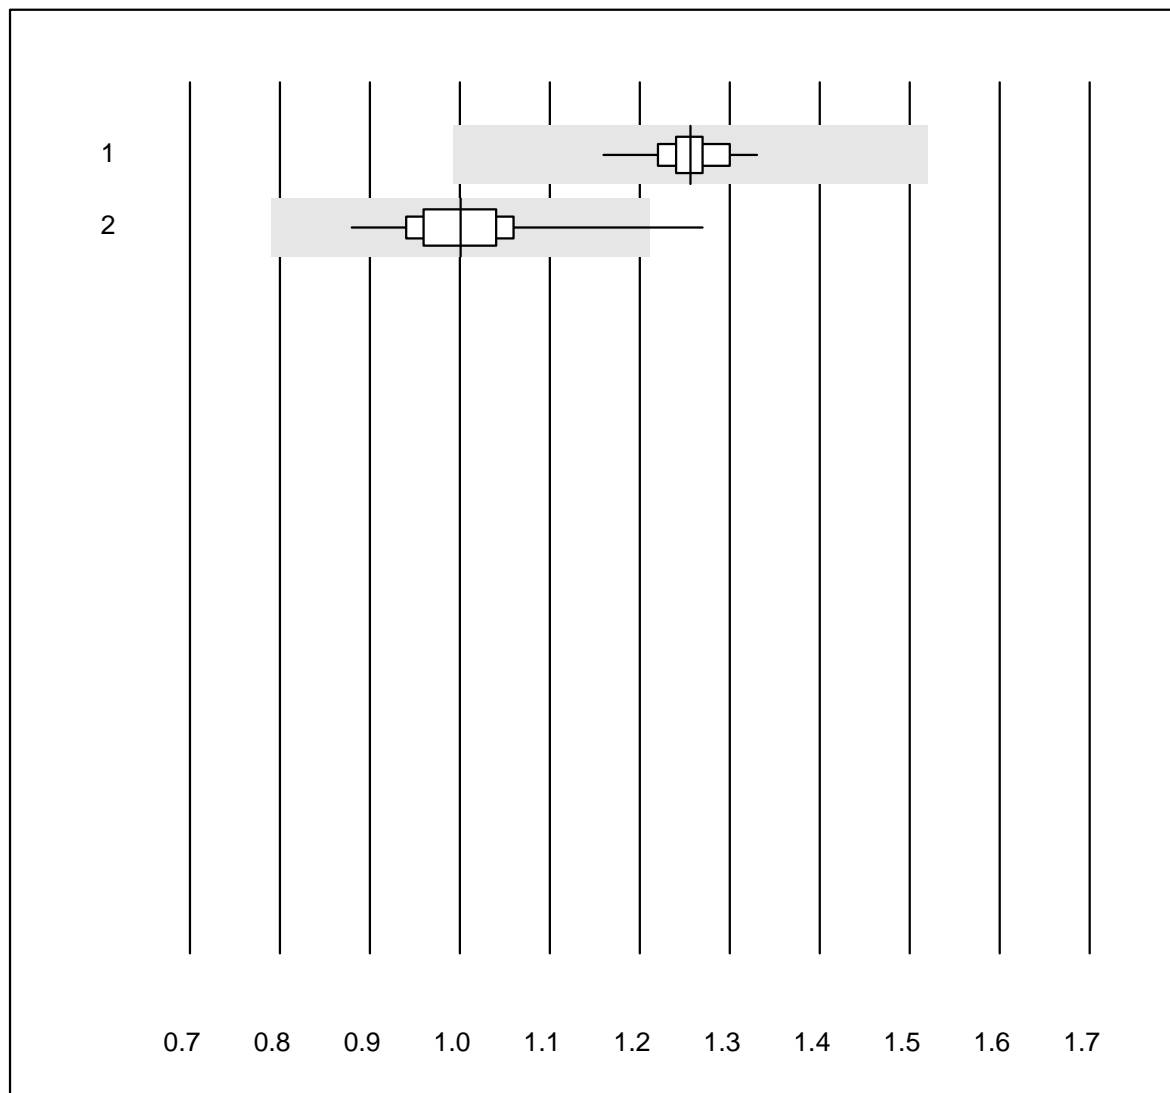

Tolérance QUALAB : 21 % Cholestérol HDL Af/b101 (mmol/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas b101	48	93.7	0.0	6.3	1.26	2.7	e
2 Afinion	286	94.1	0.3	5.6	1.00	5.4	e

Triglycerides Af/b101

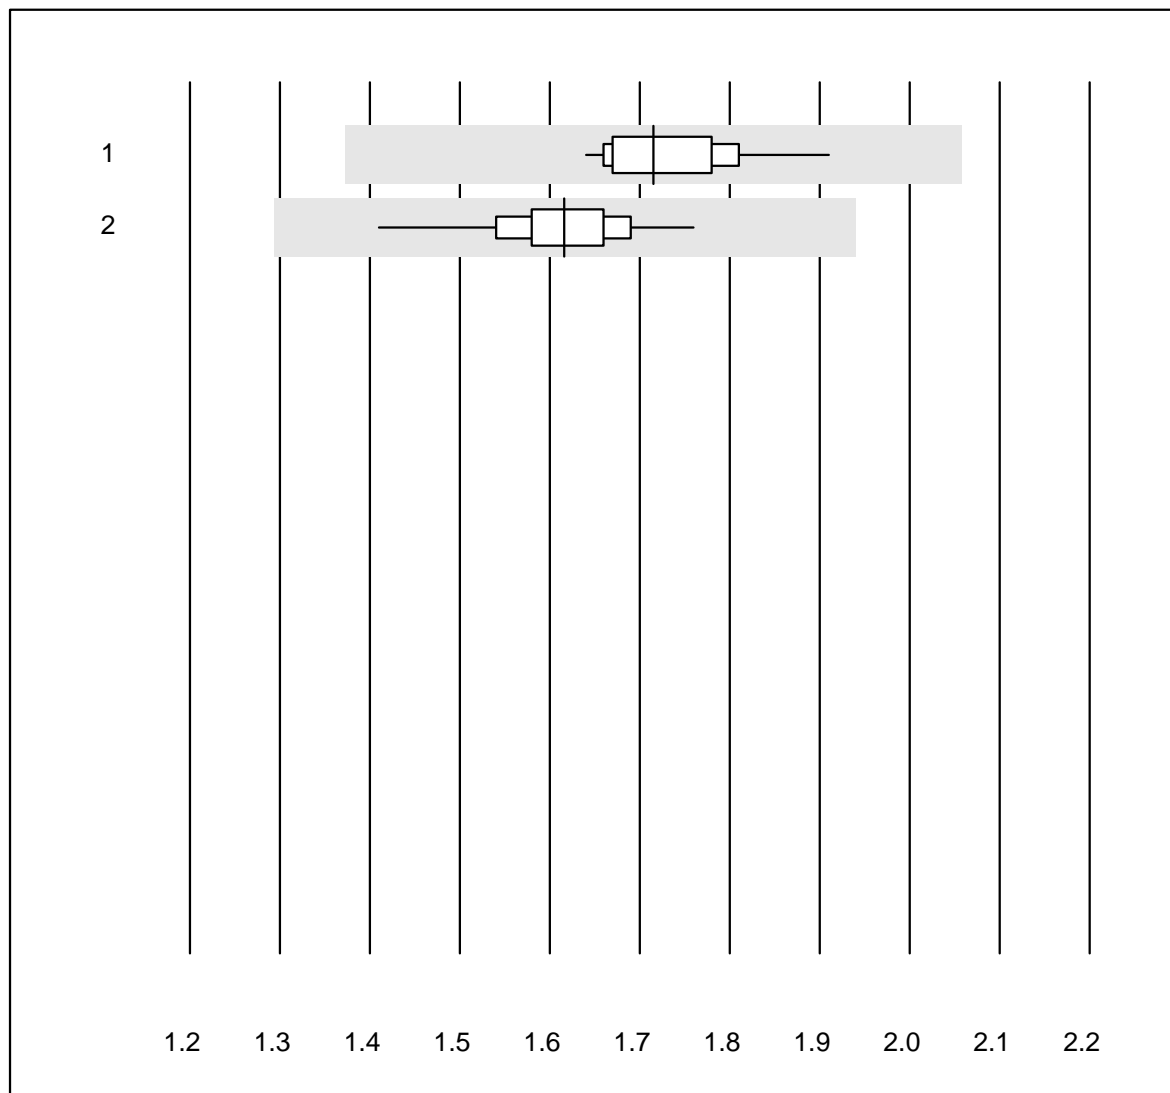


Tolérance QUALAB : 20 %

Triglycerides Af/b101 (mmol/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas b101	47	100.0	0.0	0.0	1.72	3.8	e
2 Afinion	290	99.0	0.0	1.0	1.62	3.5	e

Troponine I S

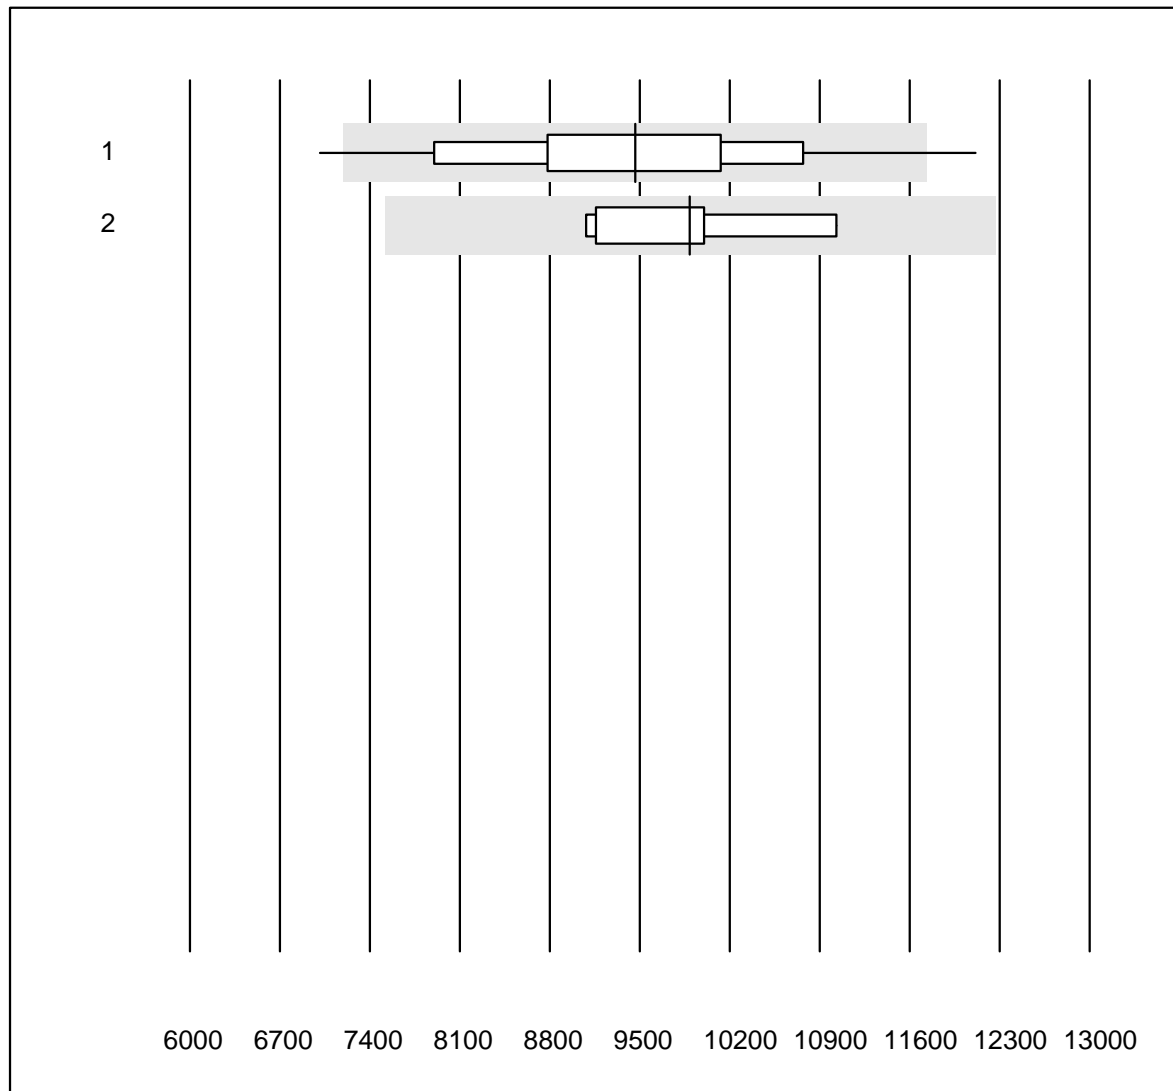


Tolérance QUALAB : 24 %

Troponine I S (ng/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Samsung LABGEO IB10	54	94.4	5.6	0.0	9465.89	11.2	e
2	AFIAS	9	88.9	0.0	11.1	9890.00	7.3	e

D-Dimères qn S

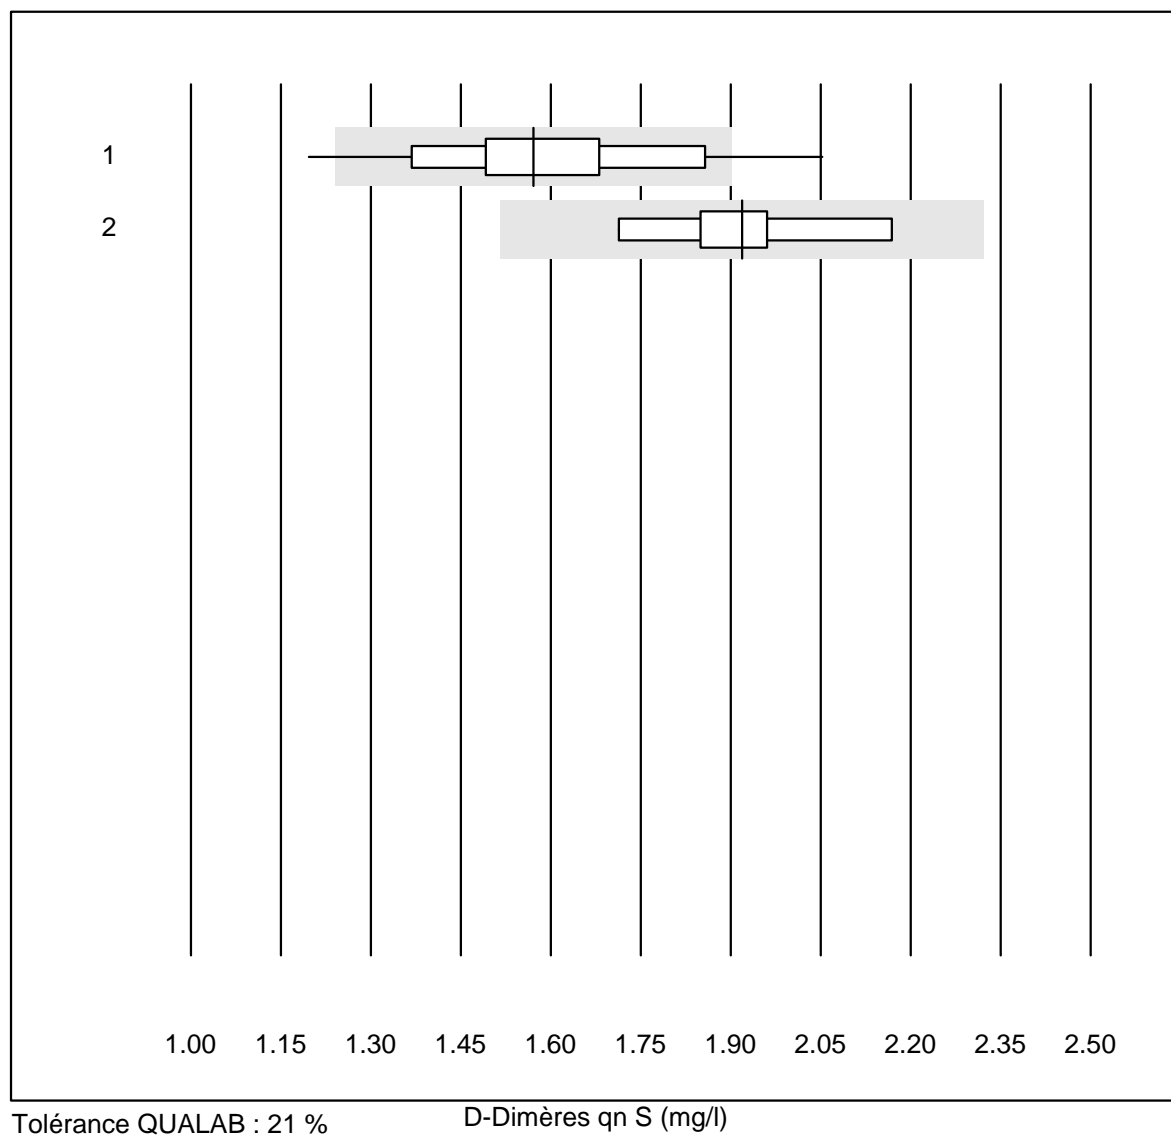

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Samsung LABGEO IB10	67	91.0	9.0	0.0	1.57	11.2	e
2	AFIAS	10	90.0	0.0	10.0	1.92	7.3	e

NT-pro BNP S

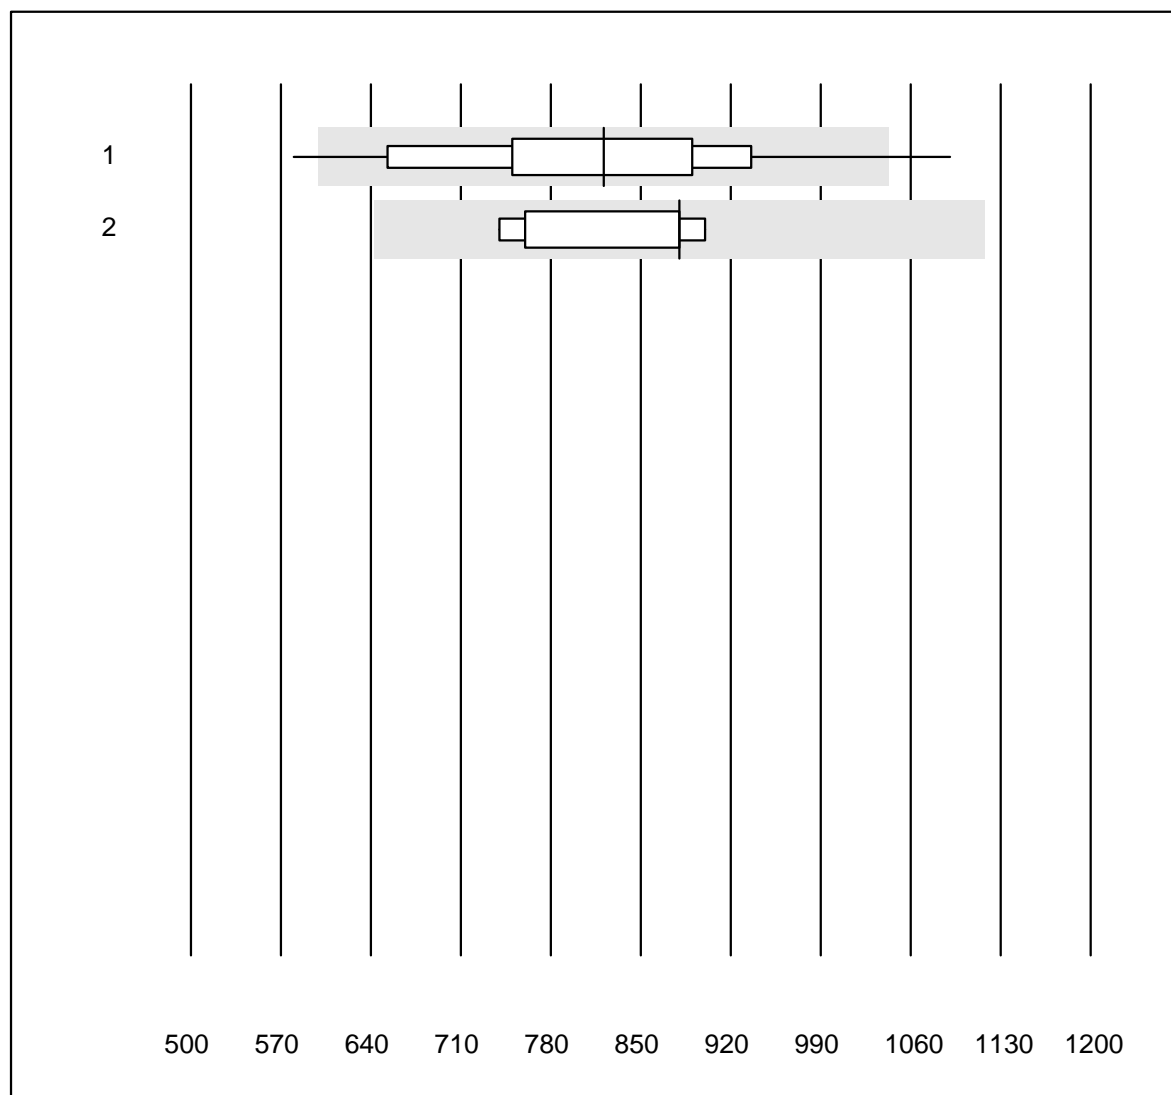


Tolérance QUALAB : 27 %

NT-pro BNP S (ng/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Samsung LABGEO IB10	43	90.7	7.0	2.3	821.4	14.5	e
2	AFIAS	9	77.8	0.0	22.2	880.0	7.6	e

INR MI

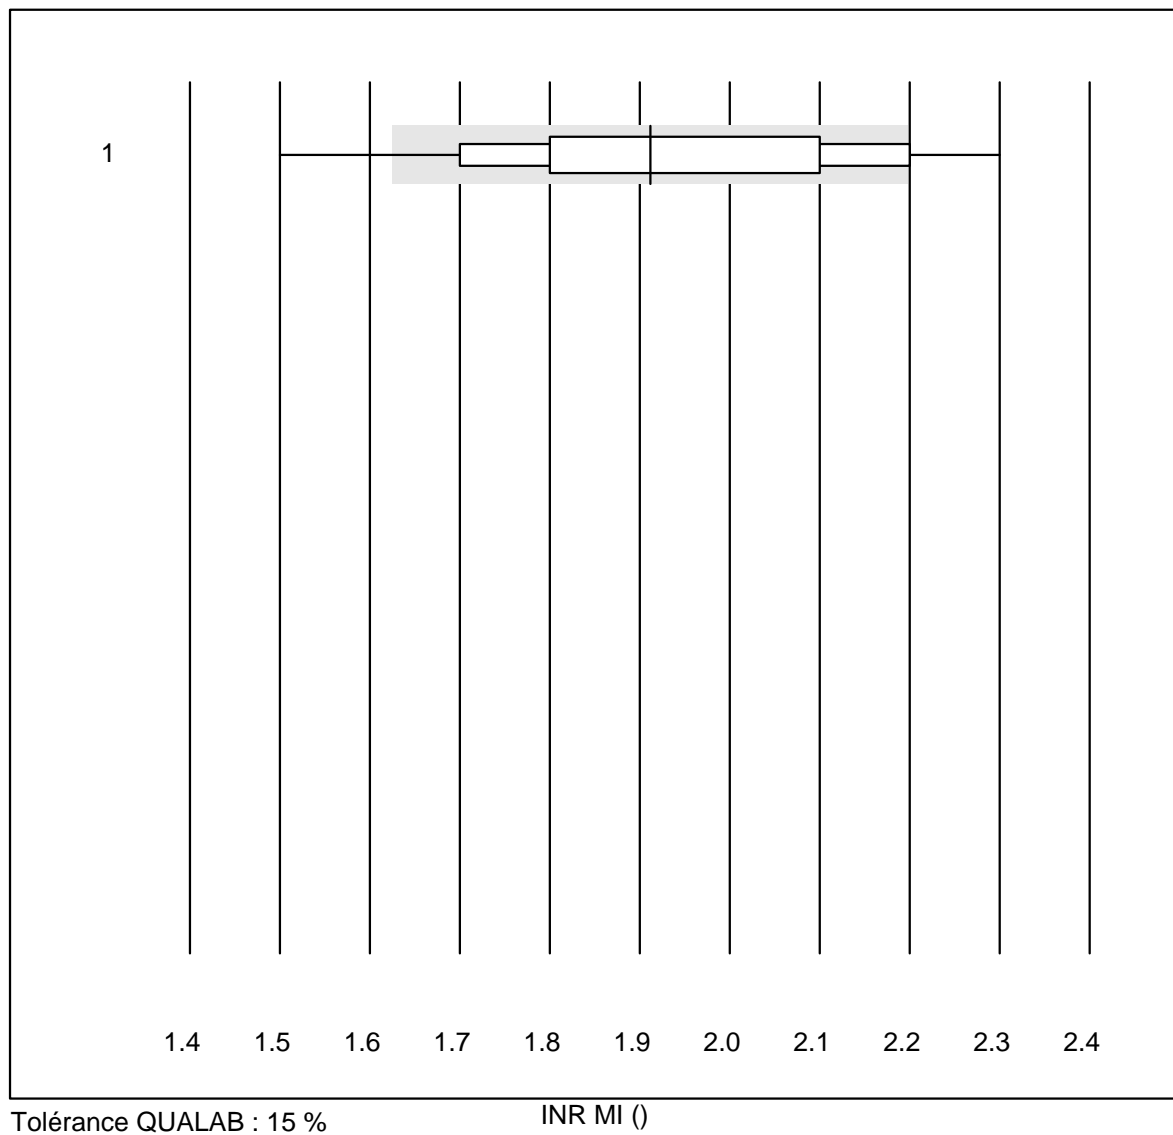

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 MicroINR	76	71.1	17.1	11.8	1.9	10.3	e

Lipase

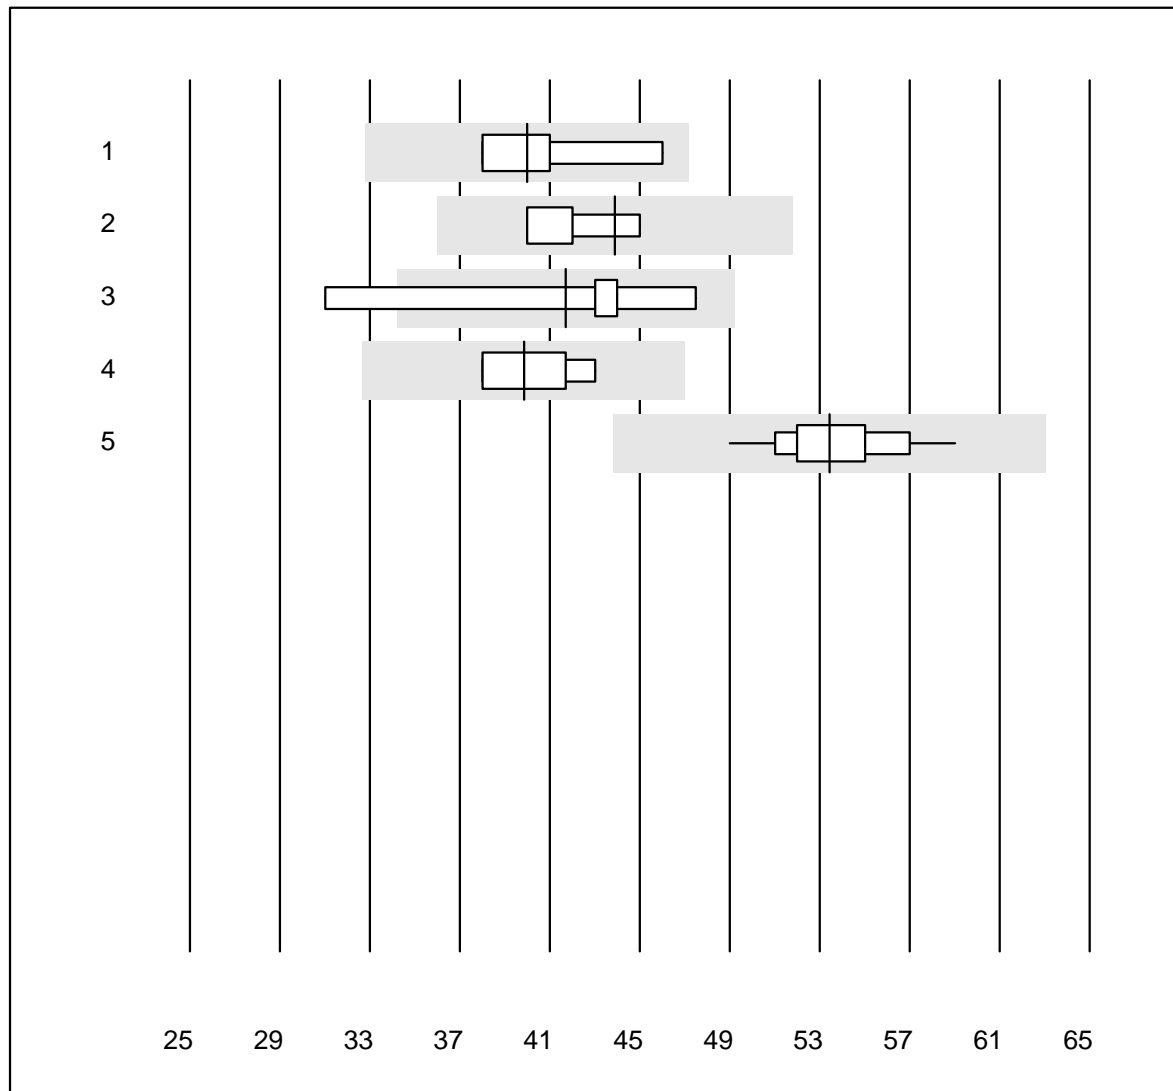


Tolérance QUALAB : 18 %

Lipase (U/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Autolyser/DiaSys	4	100.0	0.0	0.0	40.0	8.7	e*
2	Architect	4	100.0	0.0	0.0	43.9	5.7	a
3	Beckman	5	80.0	20.0	0.0	41.7	15.0	a
4	Cobas	8	100.0	0.0	0.0	39.9	4.8	e
5	Fuji Dri-Chem	86	96.5	0.0	3.5	53.4	4.5	e

INR Xprecia

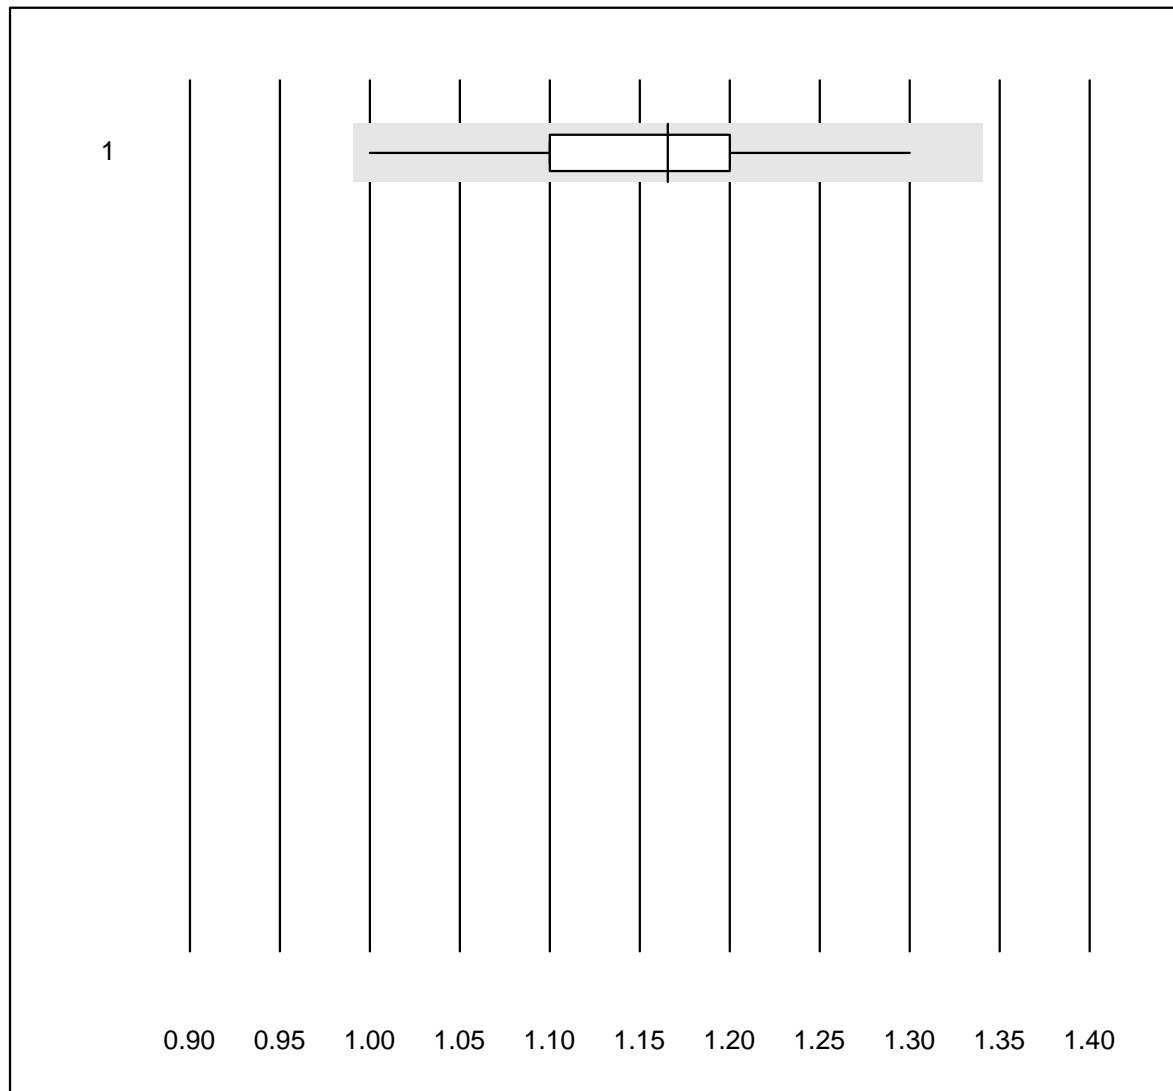


Tolérance QUALAB : 15 %

INR Xprecia ()

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Xprecia	32	100.0	0.0	0.0	1.2	6.0	e

Hémoglobine

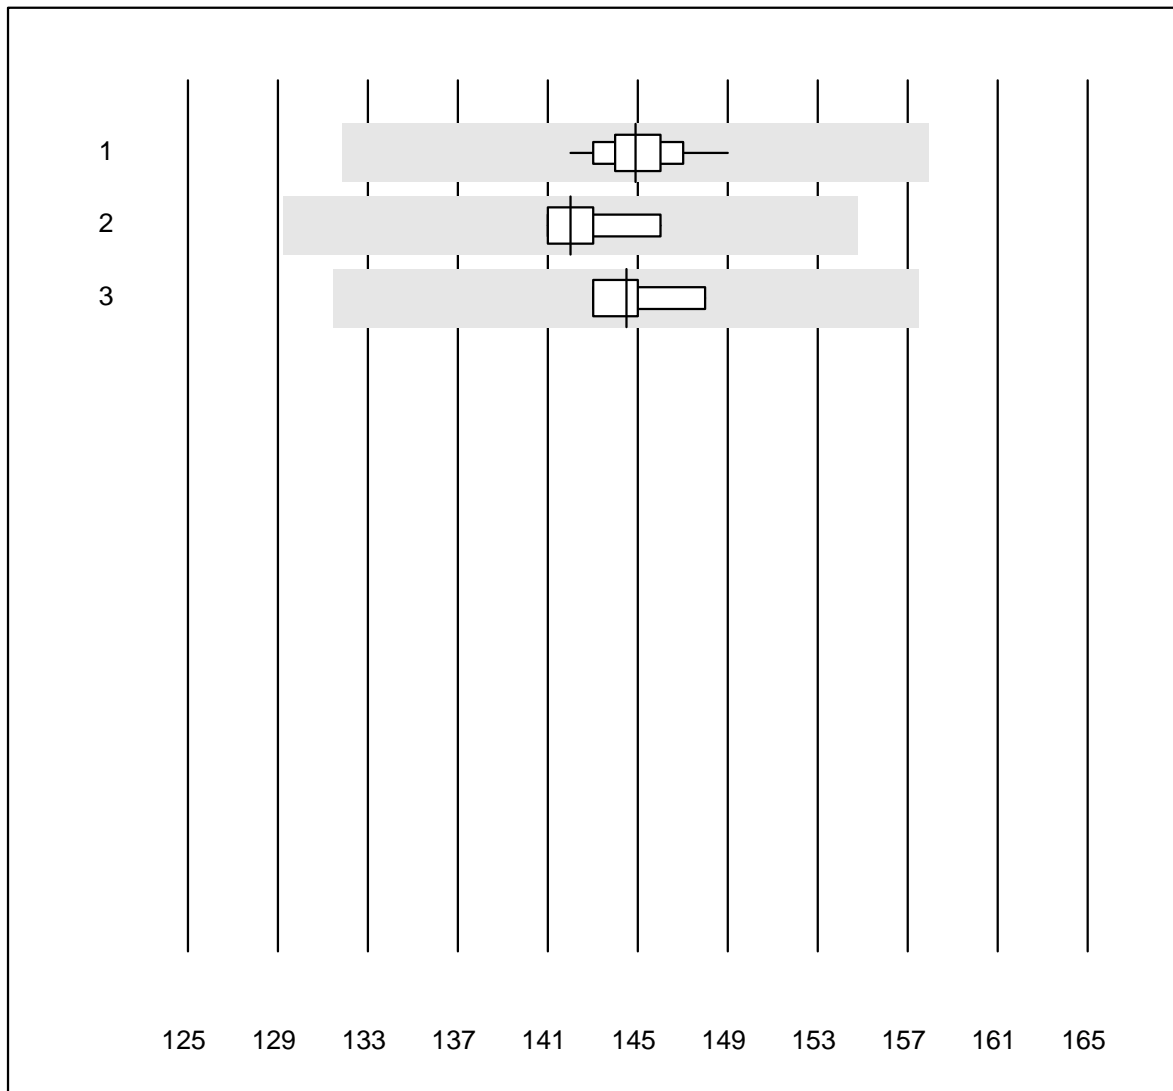


Tolérance QUALAB : 9 %

Hémoglobine (g/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Sysmex	37	100.0	0.0	0.0	144.9	1.1	e
2	Advia	5	100.0	0.0	0.0	142.0	1.5	e
3	ABX Pentra	4	100.0	0.0	0.0	144.5	1.5	e

Hématocrite

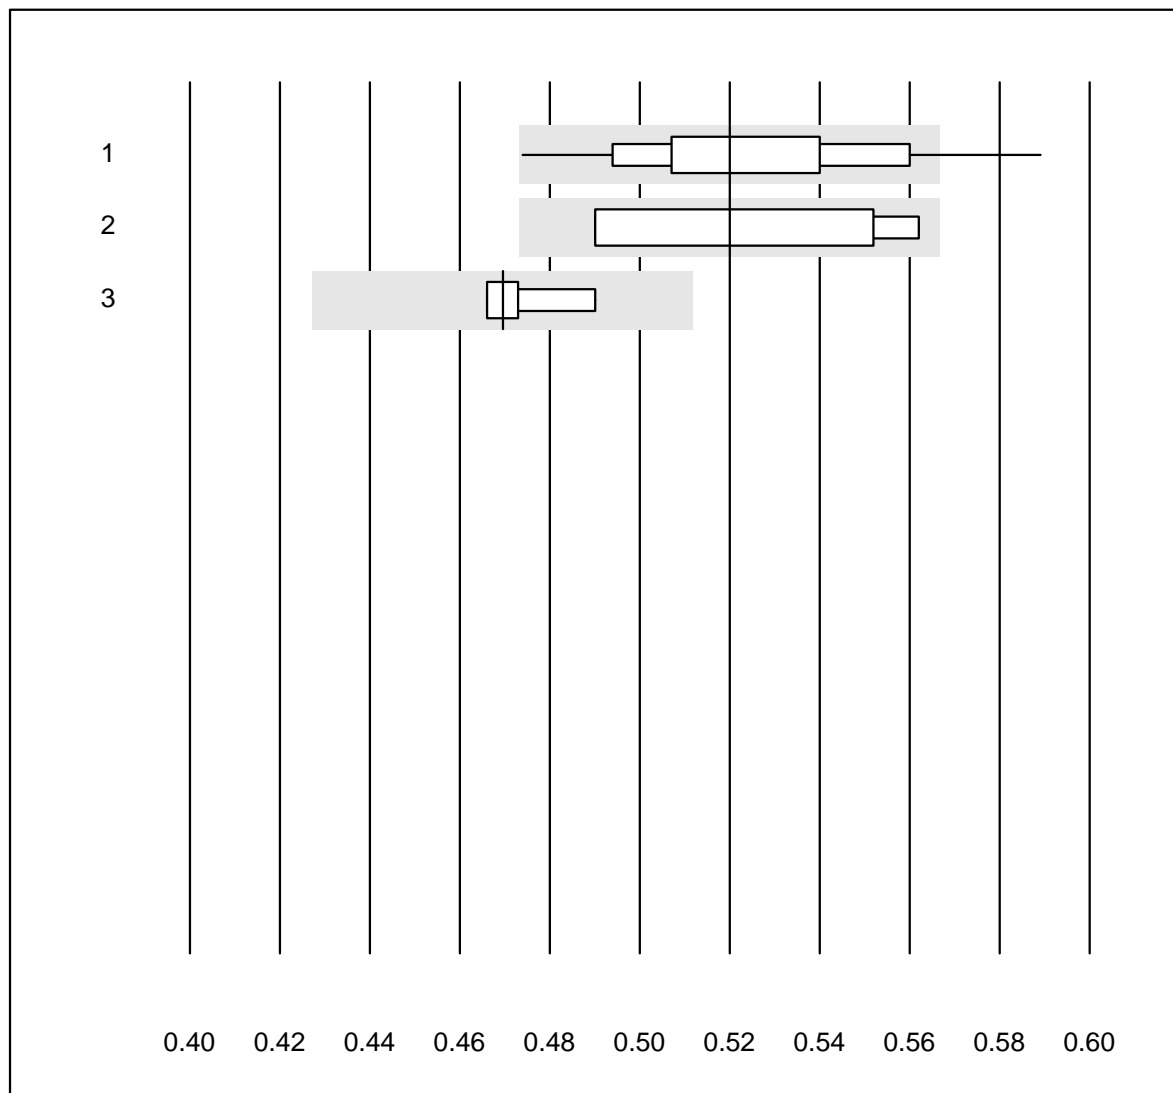


Tolérance QUALAB : 9 %

Hématocrite (l/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Sysmex	37	94.6	5.4	0.0	0.52	4.9	e
2	Advia	5	100.0	0.0	0.0	0.52	6.8	a
3	ABX Pentra	4	100.0	0.0	0.0	0.47	2.4	e*

Erythrocytes

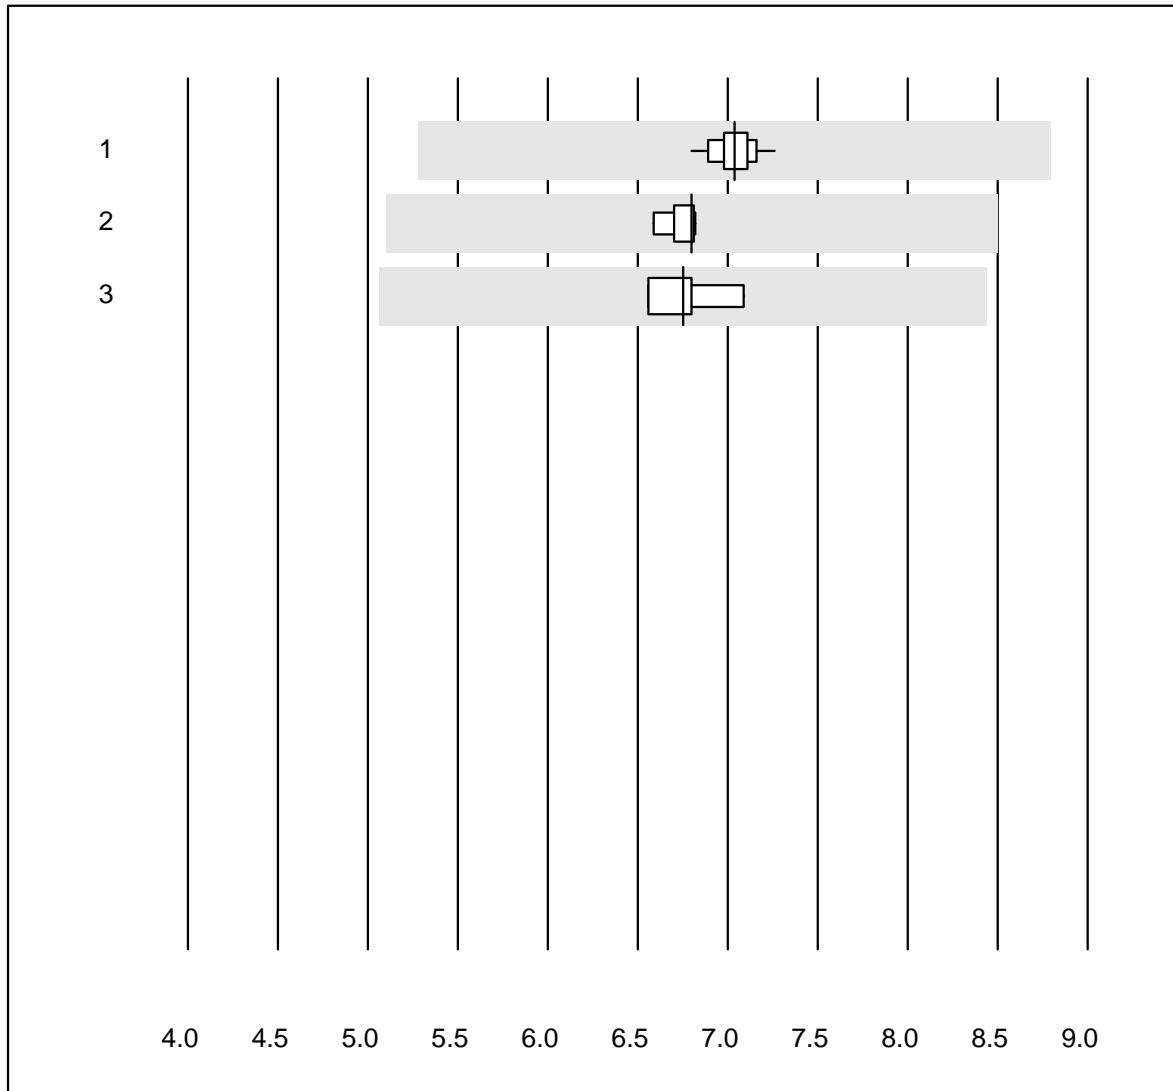


Tolérance QUALAB : 25 %

Erythrocytes (T/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Sysmex	37	100.0	0.0	0.0	7.04	1.4	e
2	Advia	5	100.0	0.0	0.0	6.80	1.5	e
3	ABX Pentra	4	100.0	0.0	0.0	6.75	3.3	e

Leucocytes

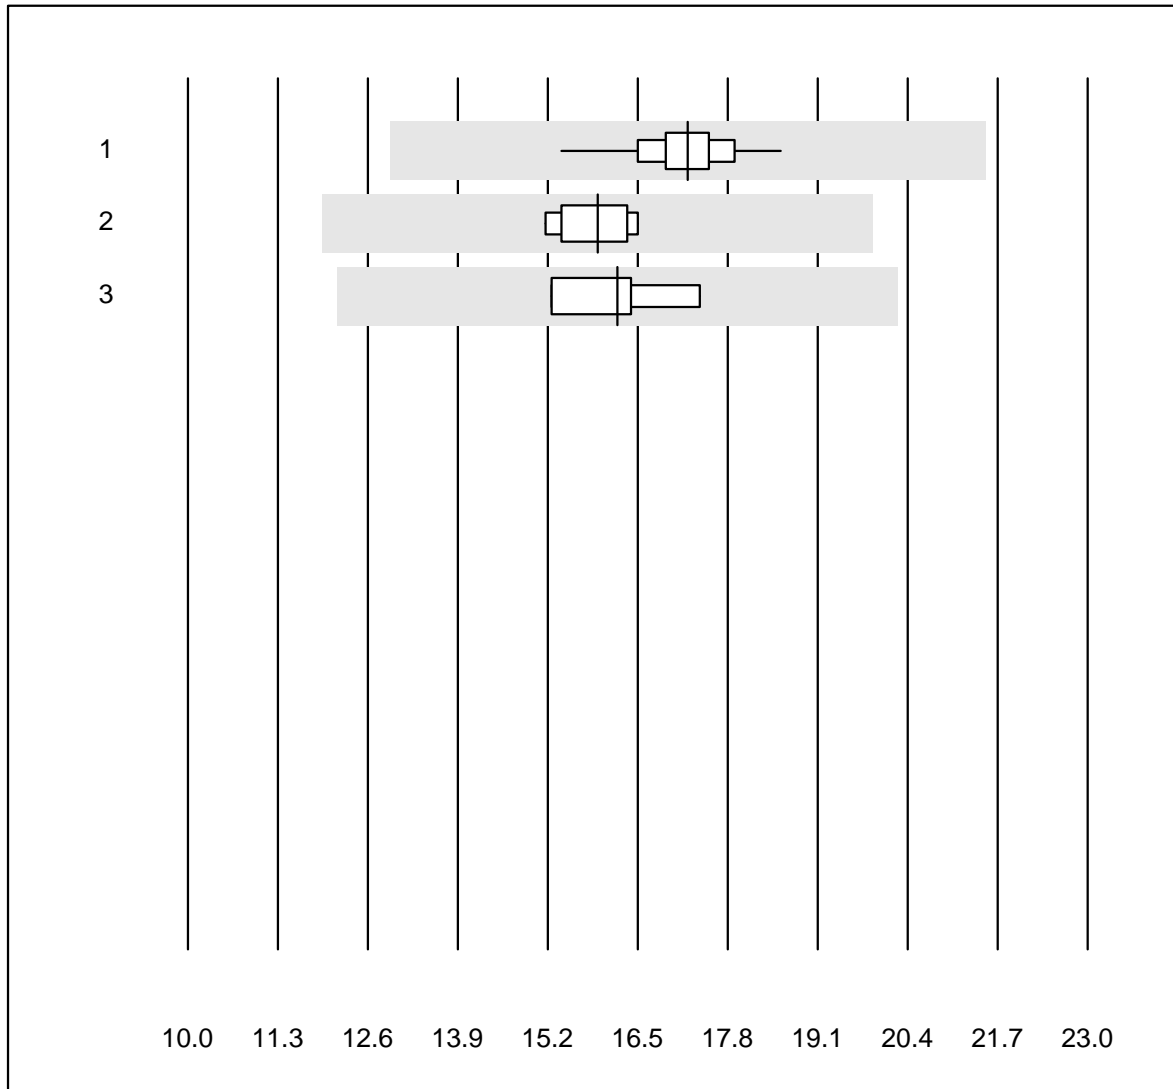


Tolérance QUALAB : 25 %

Leucocytes (G/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Sysmex	37	100.0	0.0	0.0	17.22	3.5	e
2 Advia	5	100.0	0.0	0.0	15.92	3.6	e
3 ABX Pentra	4	100.0	0.0	0.0	16.20	5.5	e

Thrombocytes

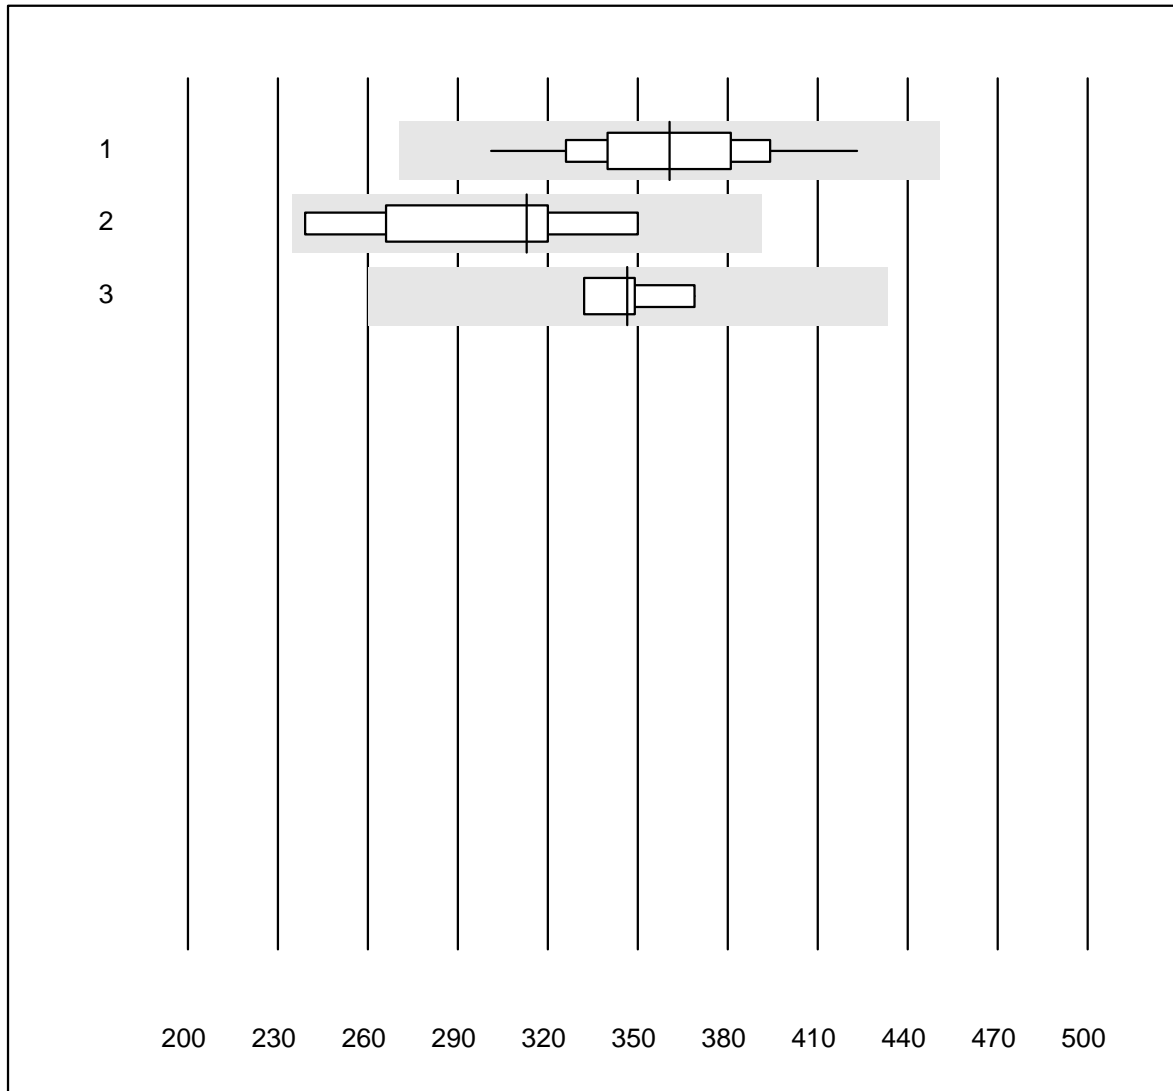


Tolérance QUALAB : 25 %

Thrombocytes (G/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Sysmex	37	97.3	0.0	2.7	360.7	7.6	e
2 Advia	5	100.0	0.0	0.0	313.0	14.9	e*
3 ABX Pentra	4	100.0	0.0	0.0	346.5	4.4	e

Neutrophiles

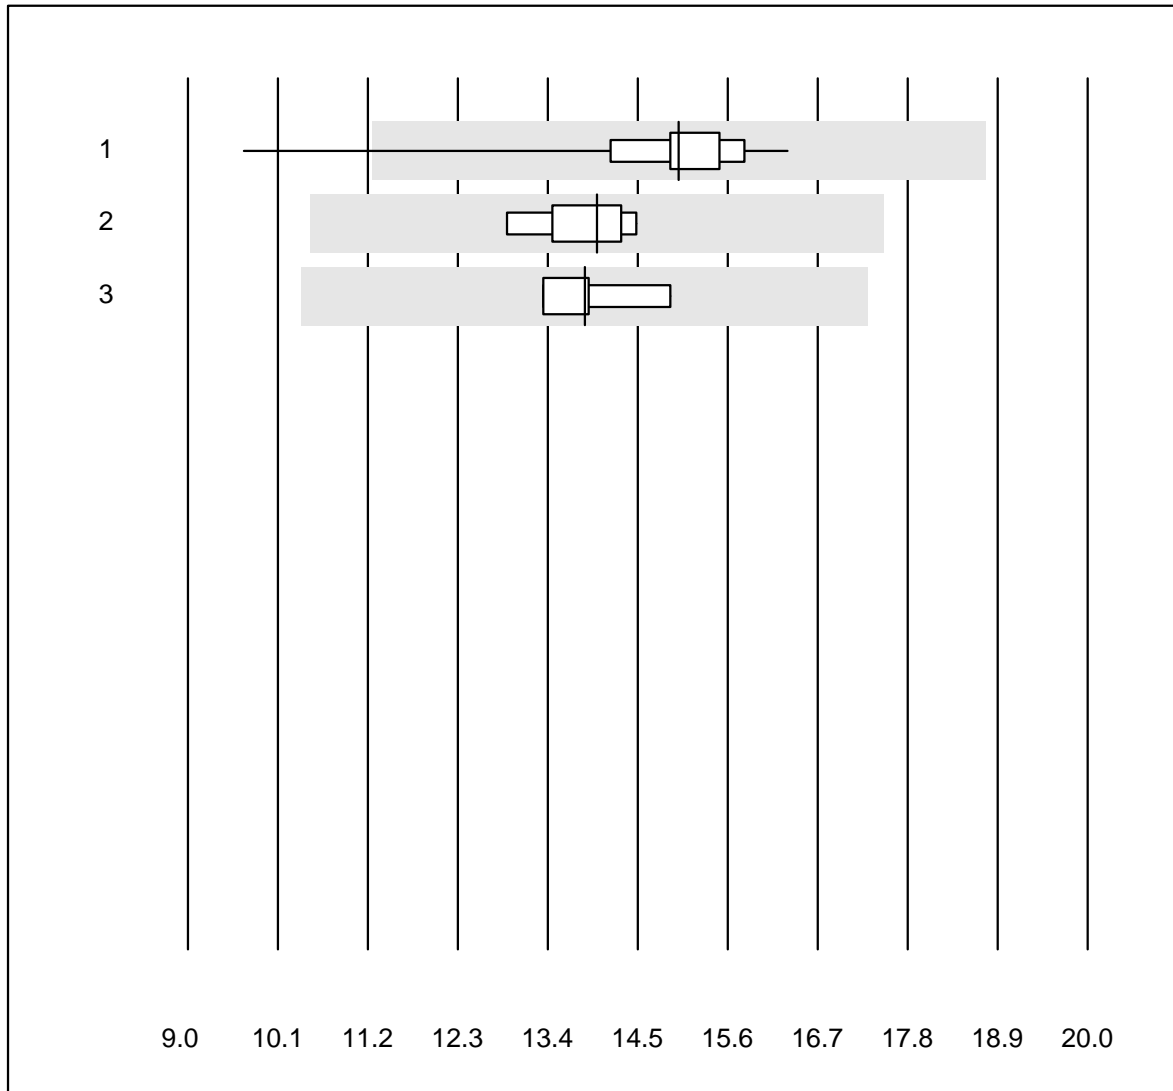


Tolérance QUALAB : 25 %

Neutrophiles (G/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Sysmex	37	97.3	2.7	0.0	15.00	7.2	e
2 Advia	5	100.0	0.0	0.0	14.00	4.7	e
3 ABX Pentra	4	100.0	0.0	0.0	13.85	4.7	e

Lymphocytes

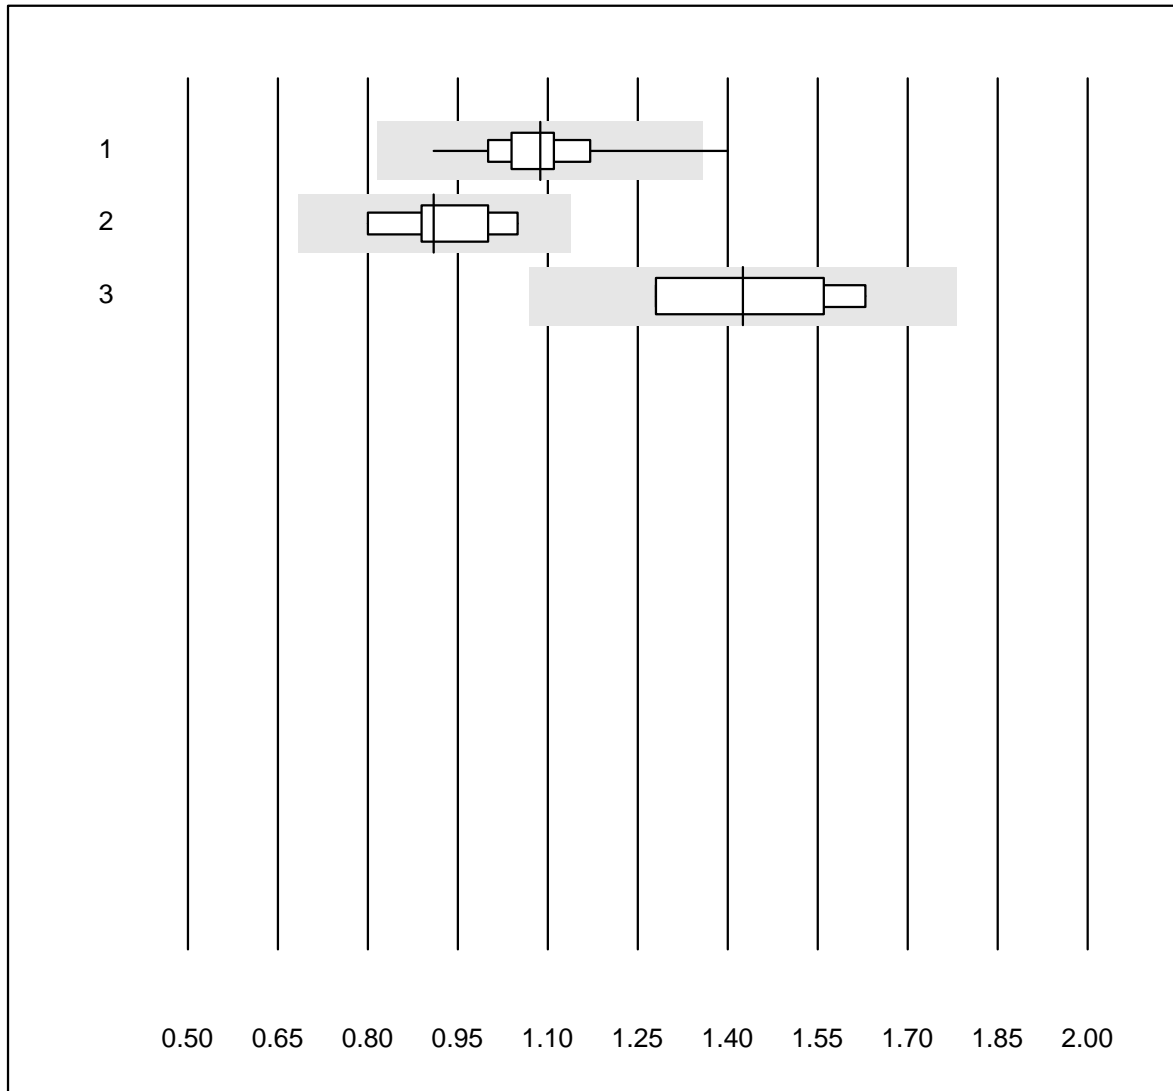


Tolérance QUALAB : 25 %

Lymphocytes (G/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Sysmex	37	94.6	2.7	2.7	1.09	7.7	e
2 Advia	5	100.0	0.0	0.0	0.91	10.5	e*
3 ABX Pentra	4	100.0	0.0	0.0	1.43	12.6	e*

Monocytes

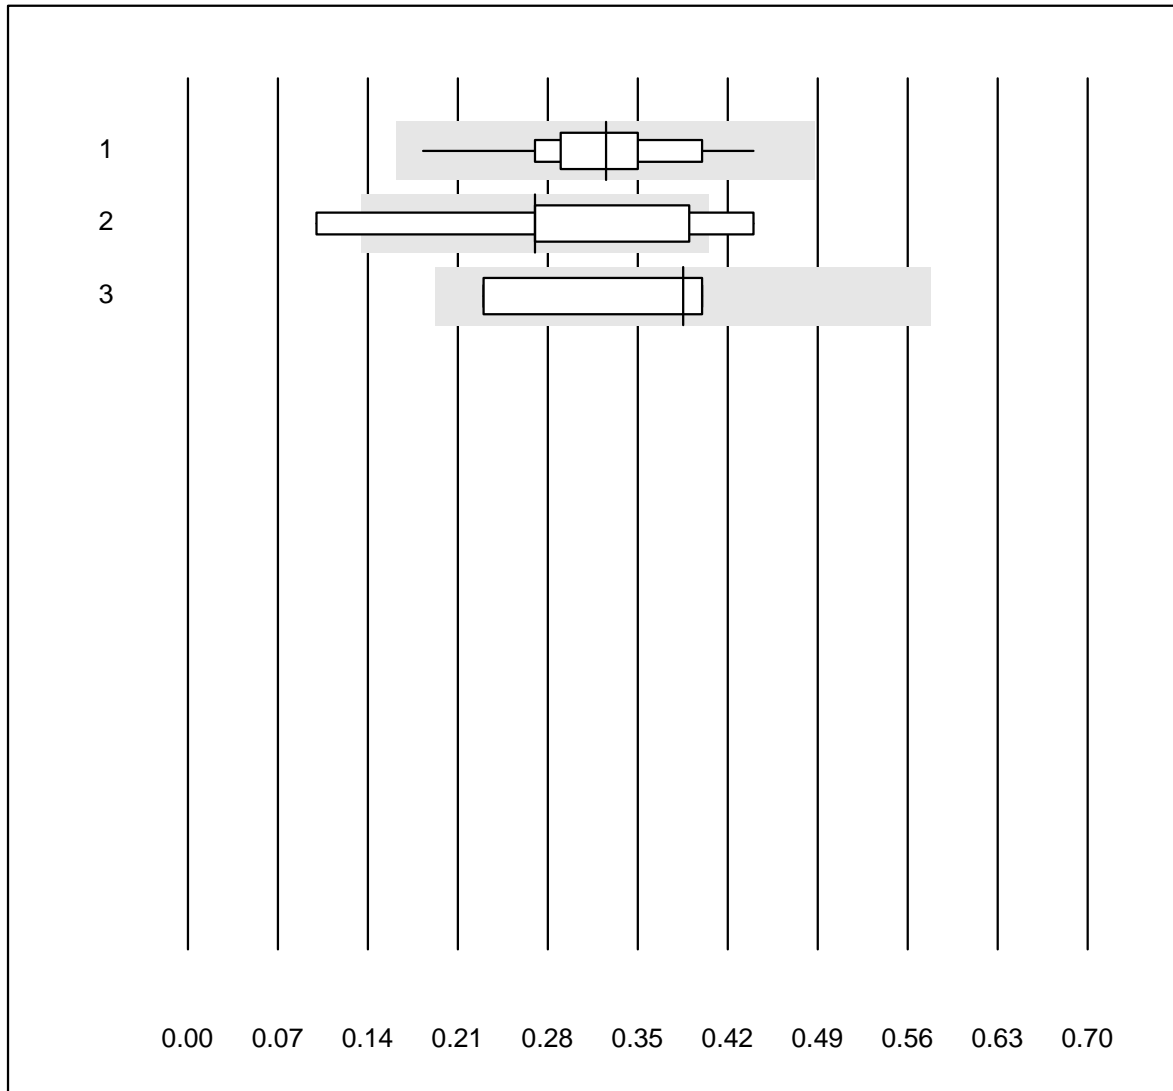


Tolérance QUALAB : 25 %

Monocytes (G/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Sysmex	37	97.3	0.0	2.7	0.33	16.3	a
2 Advia	5	60.0	40.0	0.0	0.27	44.8	a
3 ABX Pentra	4	100.0	0.0	0.0	0.39	23.2	a

Eosinophiles

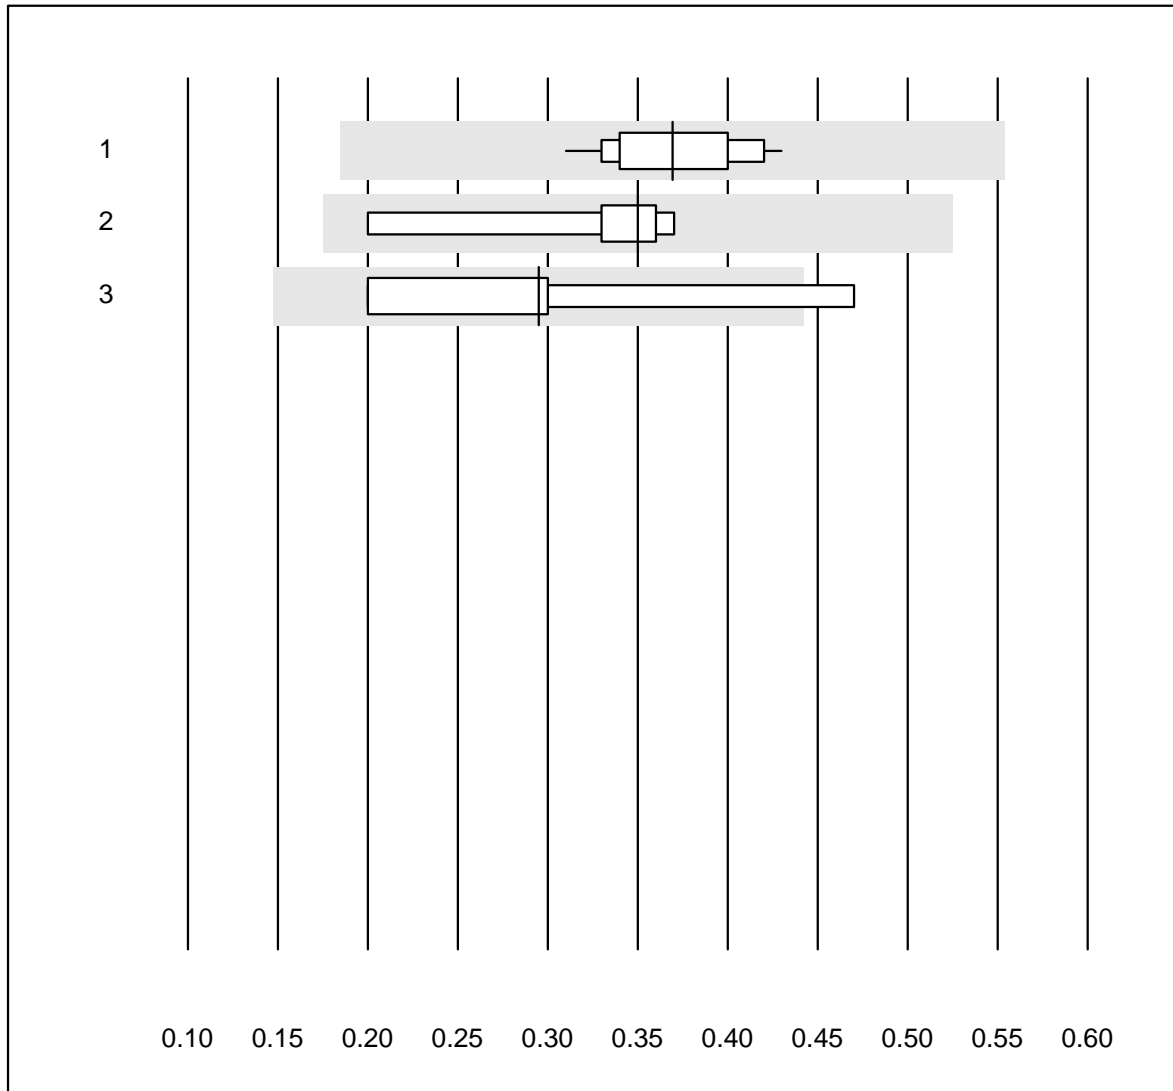


Tolérance QUALAB : 50 %

Eosinophiles (G/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Sysmex	37	97.3	0.0	2.7	0.37	9.0	e
2 Advia	5	100.0	0.0	0.0	0.35	21.7	e*
3 ABX Pentra	4	75.0	25.0	0.0	0.30	35.8	e*

Basophiles

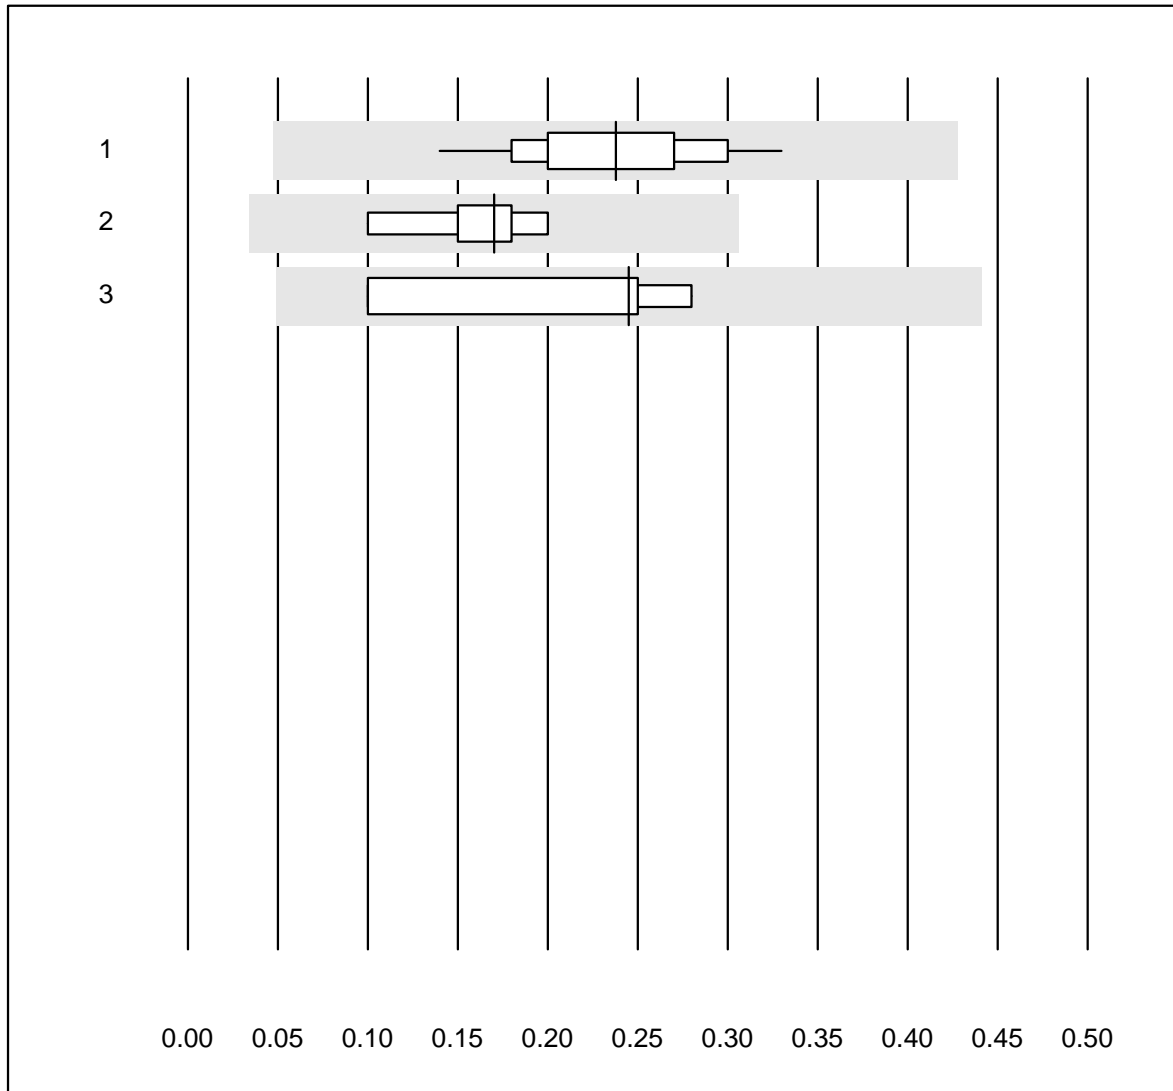


Tolérance QUALAB : 80 %

Basophiles (G/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Sysmex	37	97.3	0.0	2.7	0.24	19.8	e
2 Advia	5	100.0	0.0	0.0	0.17	23.8	e*
3 ABX Pentra	4	100.0	0.0	0.0	0.25	36.9	e*

Réticulocytes

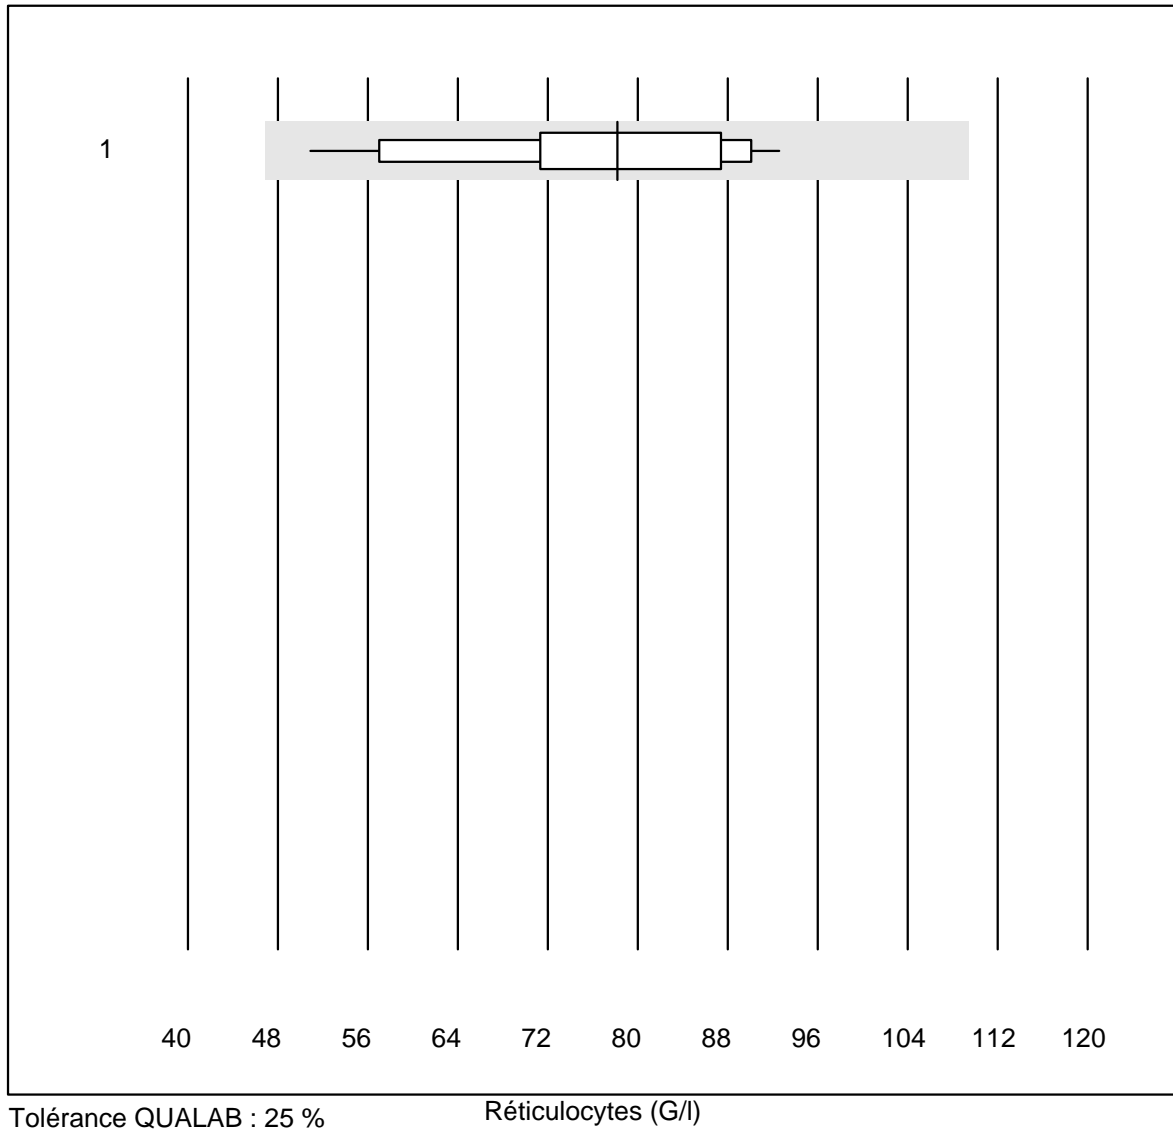

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Sysmex	19	100.0	0.0	0.0	78.2	15.1	a

Hämolyseindex Probe A

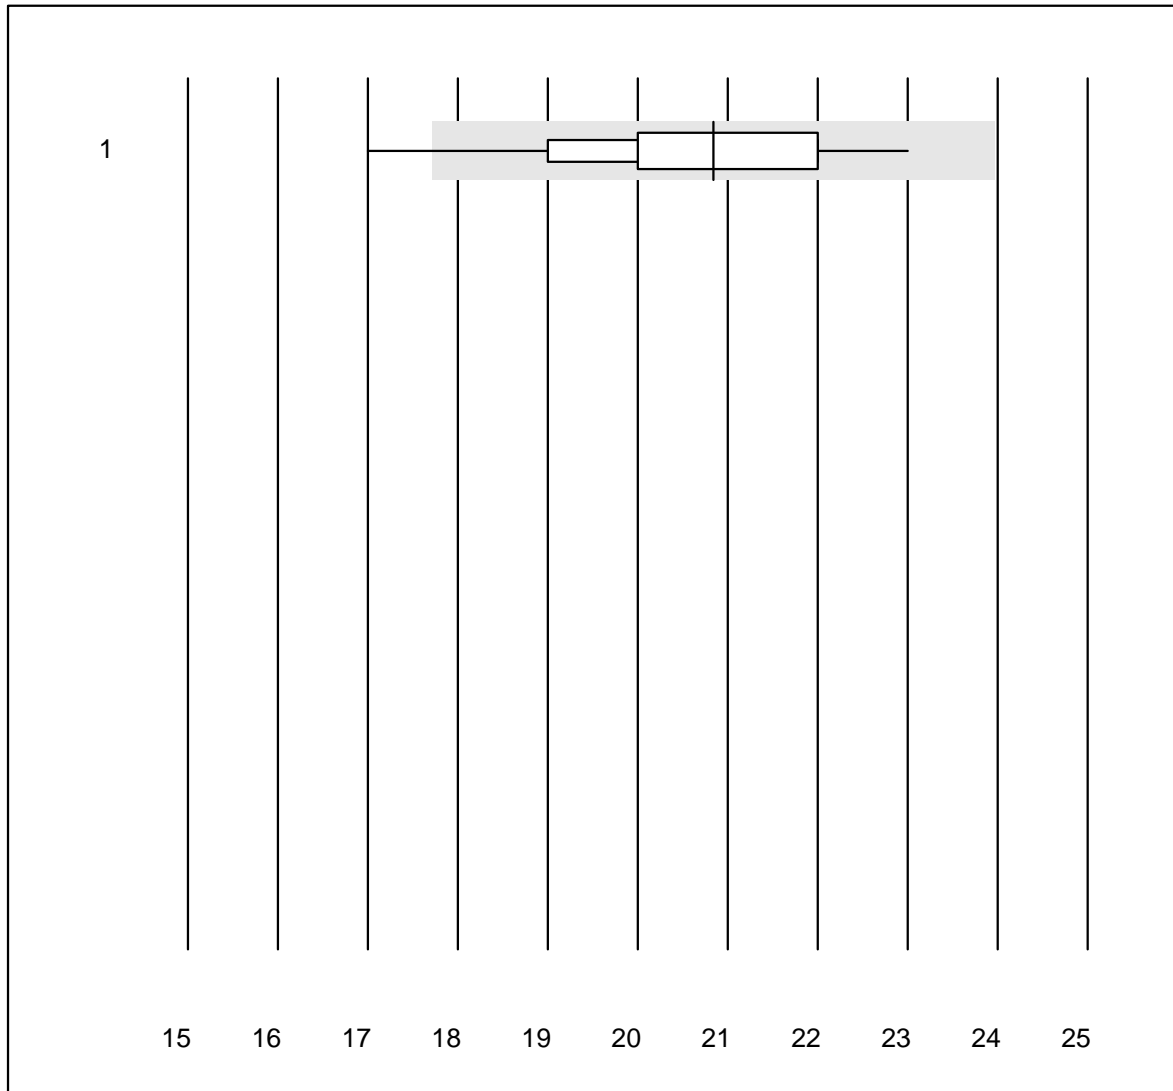


Tolérance QUALAB : 15 %

Hämolyseindex Probe A ()

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas	14	85.8	7.1	7.1	20.8	7.5	e*

Hämolyselndex Probe B

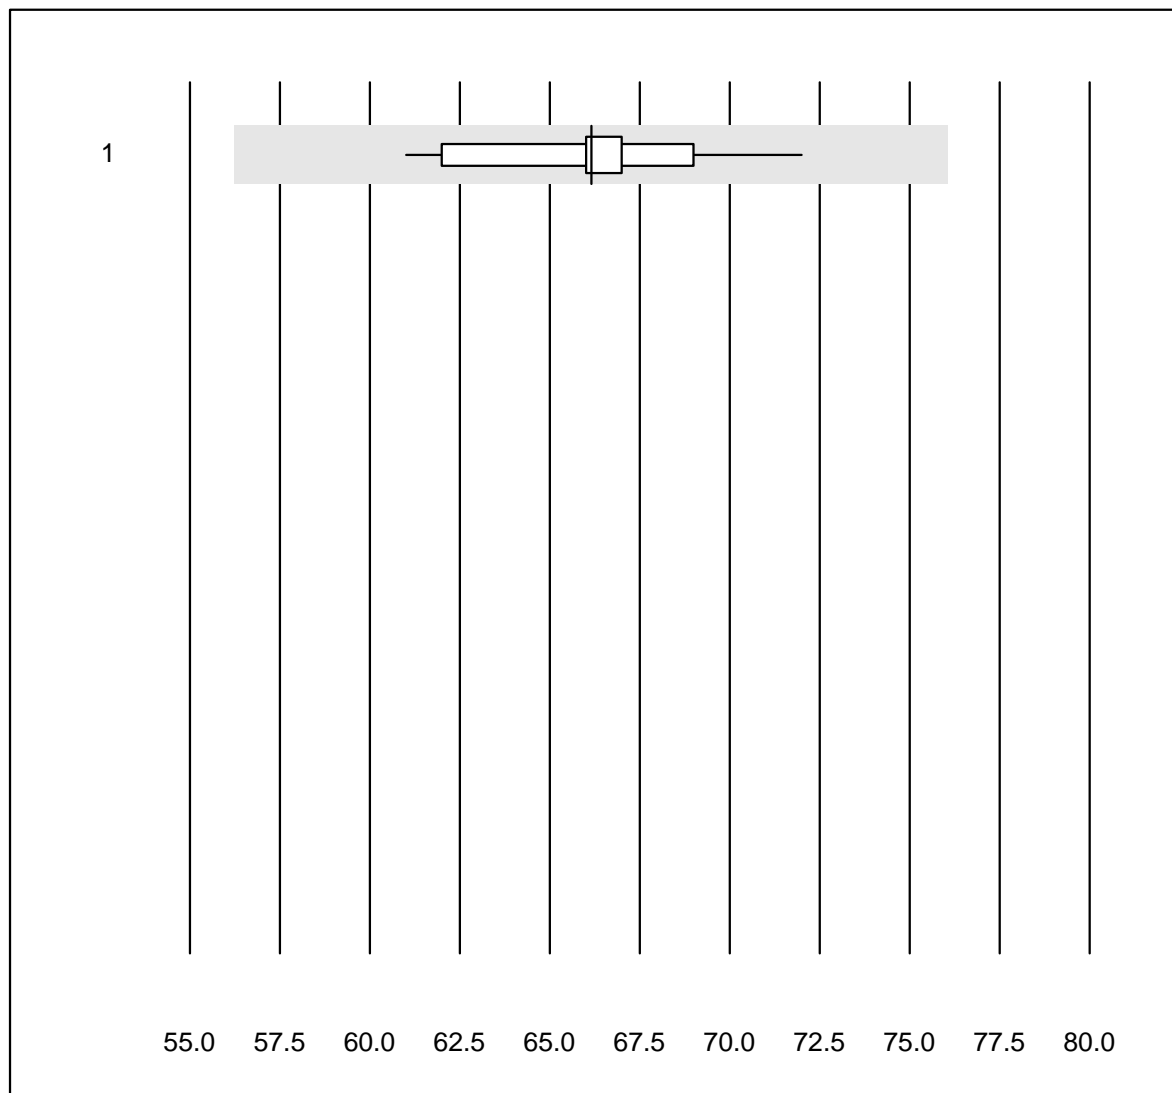


Tolérance QUALAB : 15 %

Hämolyselndex Probe B ()

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas	14	92.9	0.0	7.1	66.2	4.4	e

Vitesse de sédimentation 1h

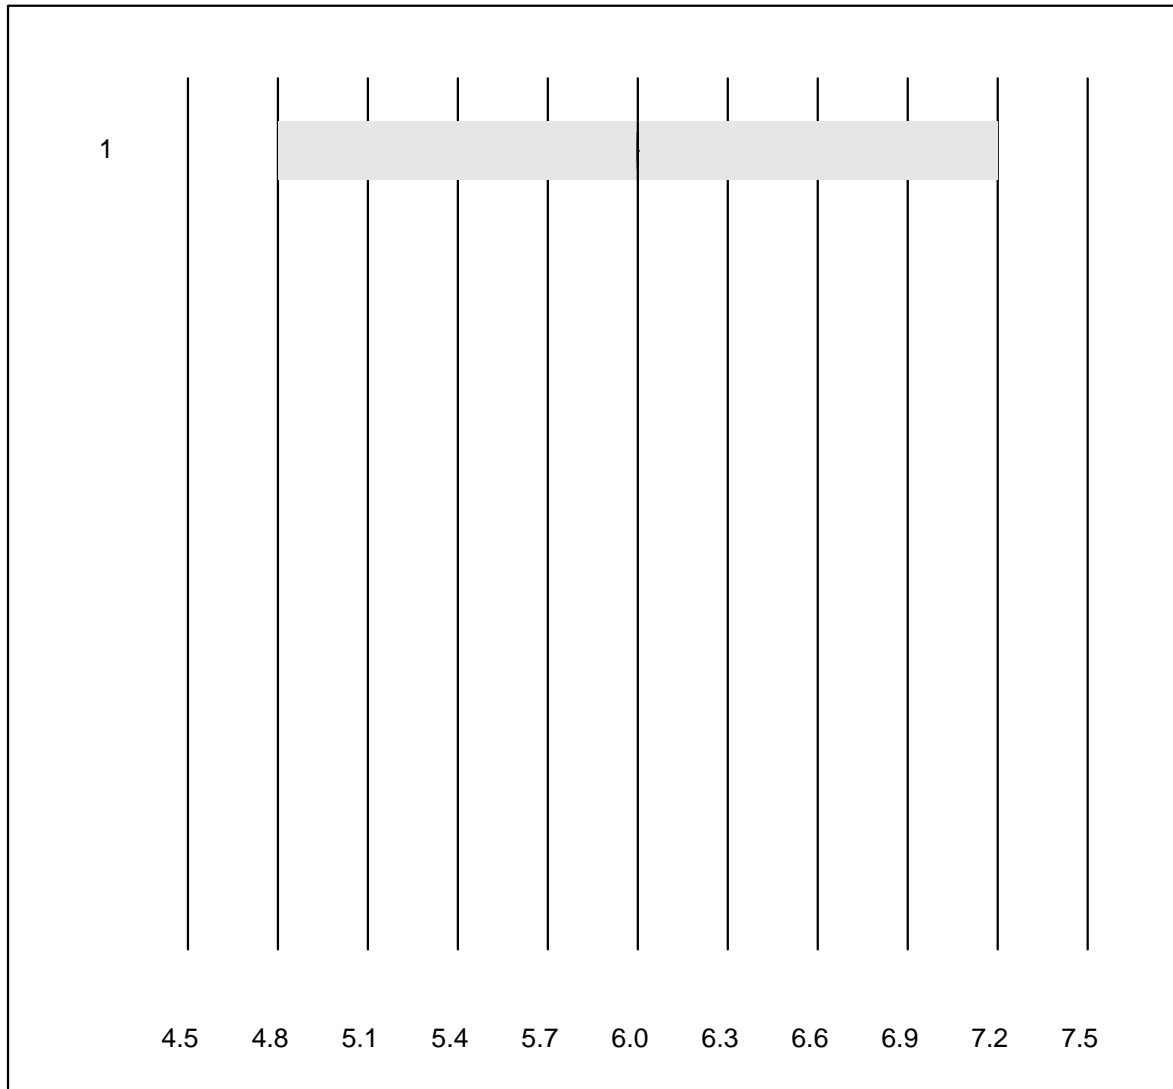

Tolérance QUALAB : 20 % Vitesse de sédimentation 1h (mm/h)

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Autres méthodes	4	50.0	0.0	50.0	6	0.0	e