

Verein für
Association pour le
Associazione per il



medizinische Qualitätskontrolle
contrôle de qualité médical
controllo di qualità medico

Commentaire de l'essai interlaboratoire

2017 - 2

Échantillons de l'essai interlaboratoire

L'homogénéité et la stabilité ont été vérifiées pour tous les échantillons avant respectivement pendant l'envoi et aucune anomalie n'a été constatée. Les tests de conformité ont été réalisés par les laboratoires de l'Hôpital Universitaire de Zürich (<http://www.uzl.usz.ch/>).

Ont été produits spécifiquement pour MQ en sous-traitance les échantillons d'essai interlaboratoire suivants:

B1 Strep A Test, B2 Uricult, H4 Hématologie parasitaire, K14 Marqueur tumoral

Détermination des valeurs-cible

Pour chaque valeur-cible est indiqué le mode de détermination utilisé selon les termes de la norme ISO17043:2010, B2.1 (Colonne "Type"):

- a Valeur connue, sur la base de la production.
- b Valeur de référence certifiée lors de l'utilisation d'échantillons spécifiques
- c Valeur de référence déterminée par analyse
- d „Consensus value“ des laboratoires d'experts
- e „Consensus value“ des participants

Pour les groupes de méthode incluant plus de 9 participants, les valeurs cibles sont déterminées comme étant la „Consensus value“ ("e") des participants. Pour la détermination de ces valeurs cibles est utilisée la moyenne réalisée par le groupe de méthodes. Les résultats qui présentent un écart par rapport à la valeur cible supérieur à 1.5 fois la tolérance Qualab, sont considérés comme résultats aberrants et exclus du calcul de la valeur de référence. Les résultats des essais d'aptitude sont utilisés comme valeur de base pour éliminer les taux aberrants. Afin de mettre à disposition de tous les participants des valeurs-cible les plus pertinentes possibles, d'autres procédures peuvent également être utilisées pour des groupes de méthode plus restreints.

Incertitude dans la détermination des valeurs-cible

L'incertitude-type (u_x) est calculée à l'aide de la formule suivante (ISO13528):

$$u_x = (\text{Valeur-cible}/100) * (1.25/\text{Racine carrée du "nombre des participants"}) * \text{CV en \%}$$

- u_x est exprimée dans la même unité que la valeur-cible
- u_x peut être comparée avec l'écart-type du collectif des participants ($\text{Ecart-type} = \text{Valeur-cible} * \text{CV en \%} / 100$)
- Pour un nombre de participants >18, l'incertitude-type (u_x) est significativement plus petite que la dispersion du collectif des participants et peut donc être négligée.


Tolérances QUALAB et MQ

Pour les analyses obligatoires sont utilisées les tolérances fixées par Qualab (www.qualab.ch, contrôle de qualité externe). Pour les analyses non-obligatoires, les tolérances sont fixées par le directeur de MQ pilotant l'essai interlaboratoire.

Si l'incertitude déterminée de la valeur de référence u_x est supérieure à 15% de la tolérance QUALAB ou de MQ, la lettre qui caractérise le type de détermination de la valeur-cible est en outre marquée d'une étoile (par exemple "e*"). Nous rendons ainsi les participants attentifs au fait que l'incertitude de la valeur de référence peut avoir une influence sur l'évaluation.

Représentation graphique

La représentation graphique des résultats est la suivante:

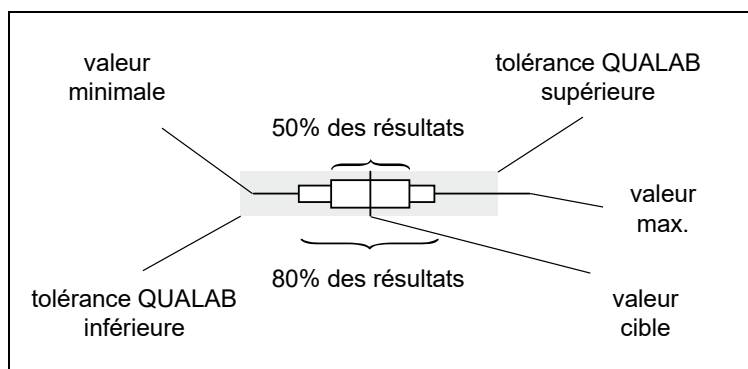


Comparaison des appareils

Les données de ce rapport vous permettent de comparer les performances respectives des divers appareils. Toutefois, vous devez tenir compte des points suivants:

- Le contrôle Chimie K1 est un sérum de contrôle commercialisé prêt à l'emploi. Même si l'échantillon est d'origine humaine, des effets matriciels sont possibles. Ceux-ci dépendent de l'appareil et peuvent générer des valeurs cible différentes.
- Seul un échantillon a été mesuré. La dispersion des résultats étant dépendante de la nature de l'échantillon (effets matriciels) et du niveau du résultat, les coefficients de variation déterminés (CV en %) ne sont pas toujours valables.
- Une grande partie des taux aberrants est due à des erreurs administratives (erreur d'unité, confusion des résultats) ou à des erreurs de manipulation (erreur d'échantillon, dissolution incorrecte, mélange insuffisant) et n'a rien à voir avec le type d'appareil.


Zürich, 17.6.2017



Dr. R. Fried
Directeur de l'essai interlaboratoire

Il n'est pas autorisé de publier une partie ou l'intégralité de ce rapport sans notre accord écrit préalable. L'original est conservé dans les archives sous www.mqzh.ch.

Quick OA

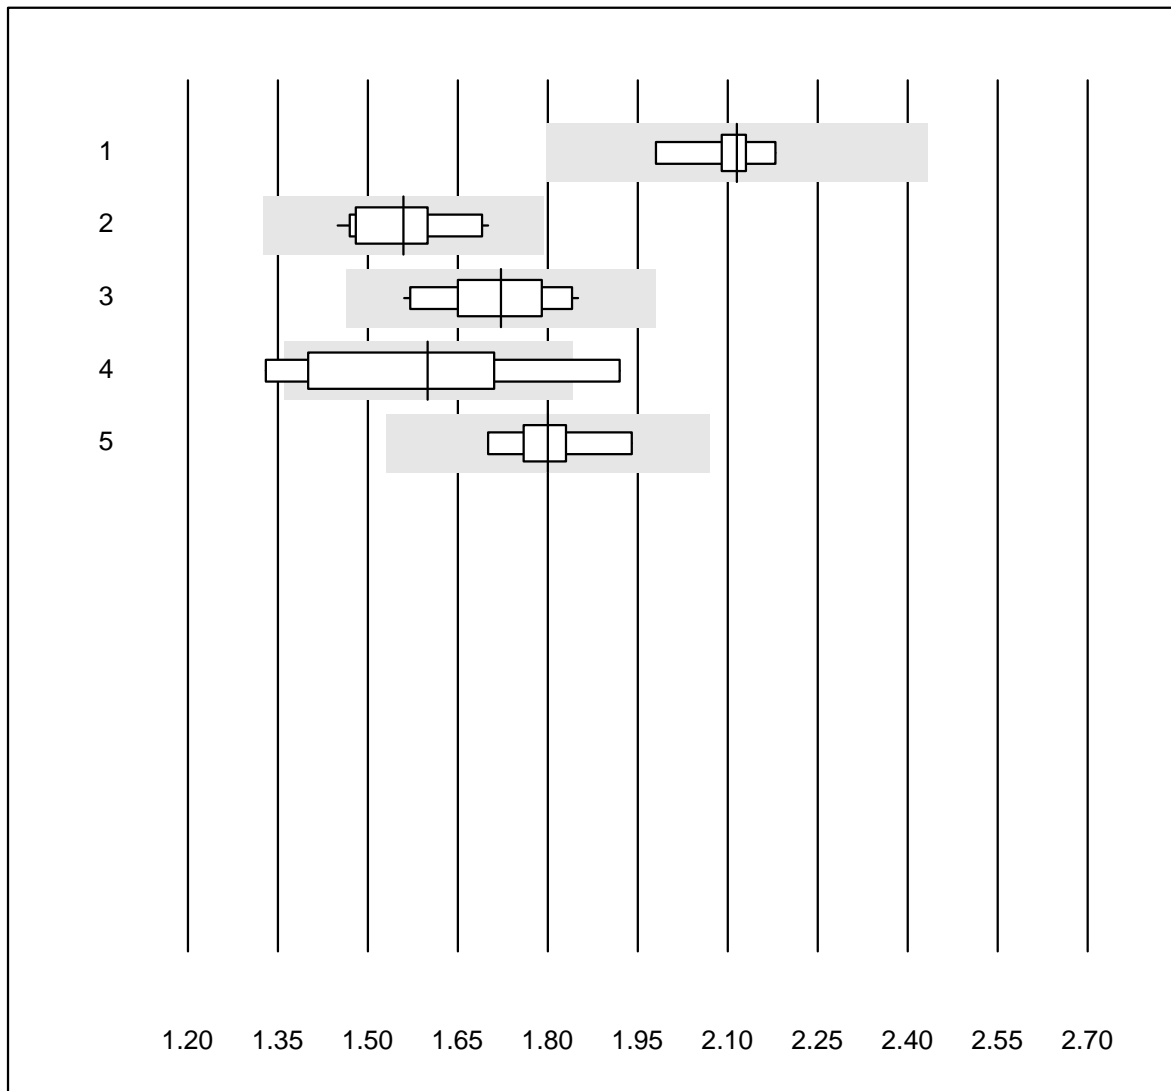


Tolérance QUALAB : 15 %

Quick OA ()

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Neoplastin Plus	6	100.0	0.0	0.0	2.12	3.2	e
2 Innovin	16	100.0	0.0	0.0	1.56	4.7	e
3 Recombiplastin 2G	17	100.0	0.0	0.0	1.72	5.5	e
4 Eurolyser	6	66.7	33.3	0.0	1.60	13.7	e*
5 Neoplastin R	9	100.0	0.0	0.0	1.80	3.9	e

Fibrinogène OA

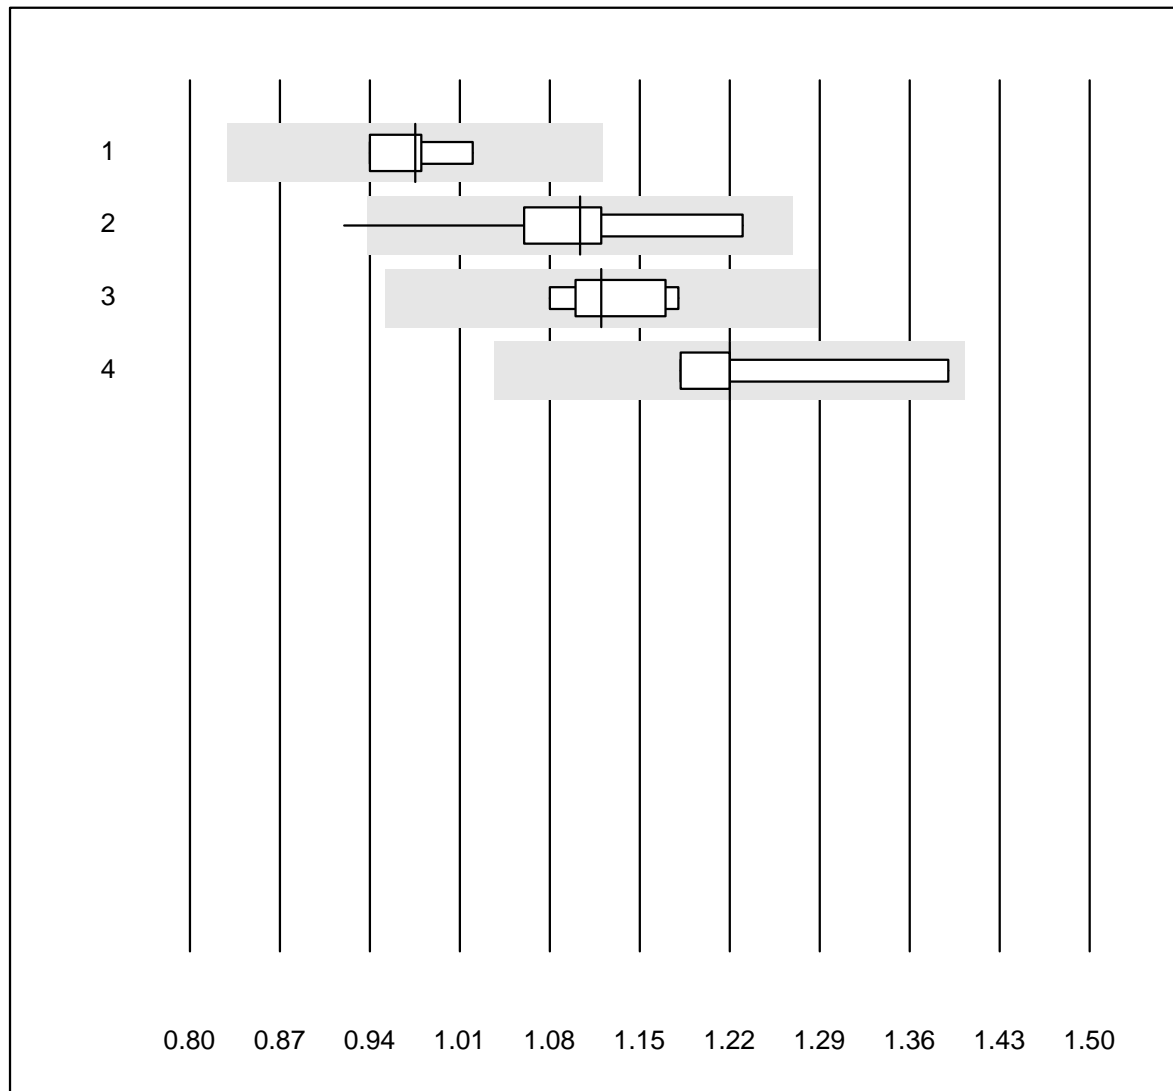


Tolérance QUALAB : 15 %

Fibrinogène OA (g/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Siemens Thrombin	4	100.0	0.0	0.0	0.98	3.4	e
2	Stago/STA	12	91.7	8.3	0.0	1.10	7.4	e*
3	Fibrinogen Q.F.A.	7	100.0	0.0	0.0	1.12	3.3	e
4	Fib Clauss (IL)	4	100.0	0.0	0.0	1.22	7.4	e*

aPTT OA

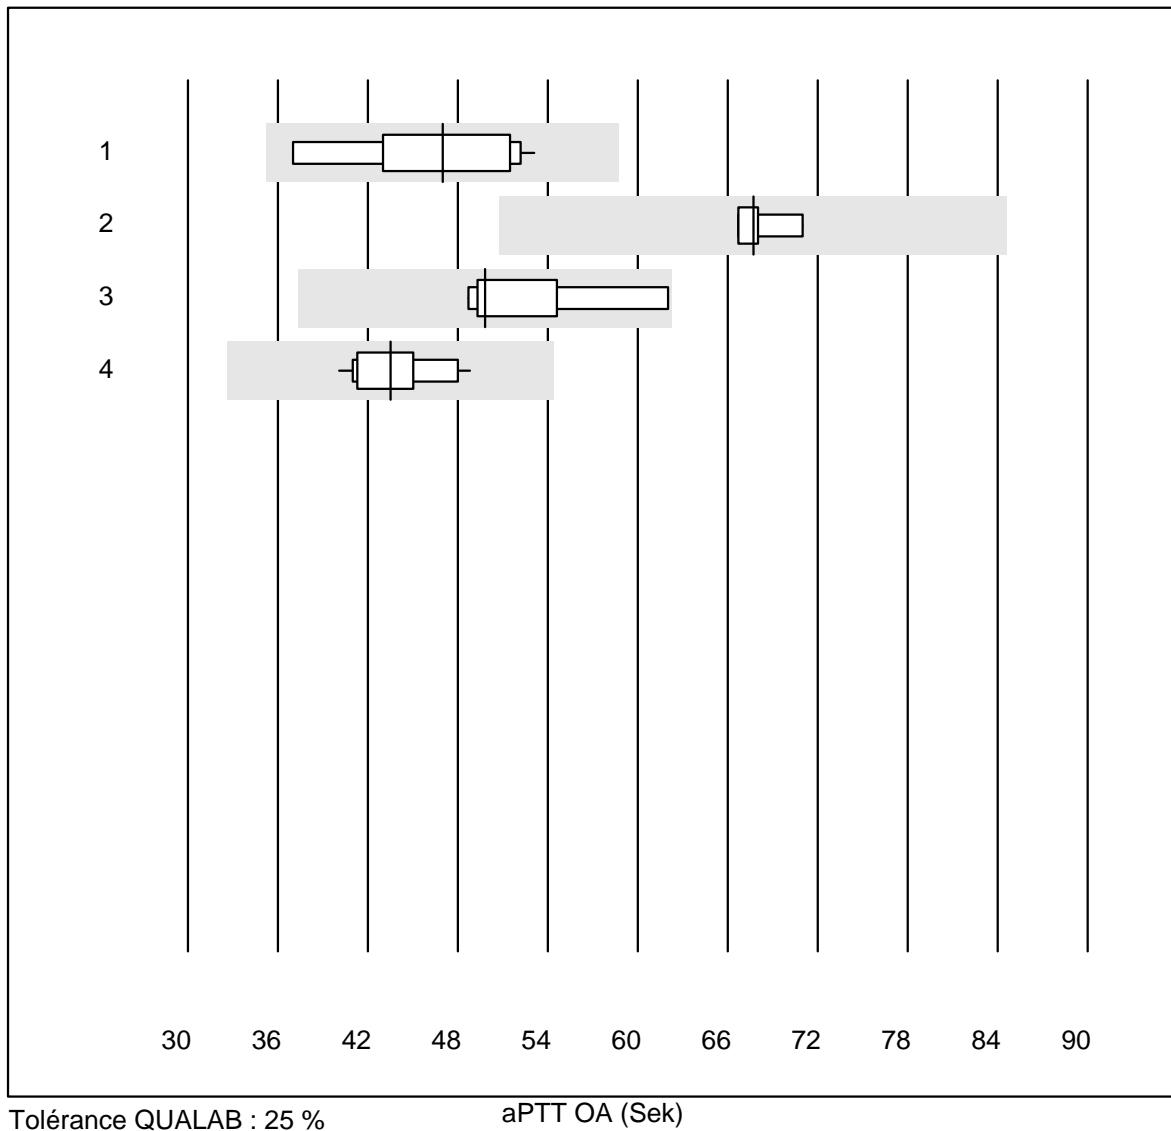

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Actin FS	10	100.0	0.0	0.0	47.0	11.7	e*
2	Pathromtin SL	4	100.0	0.0	0.0	67.7	2.8	e
3	Stago/STA	9	100.0	0.0	0.0	49.8	8.4	e
4	aPTT-SP	12	100.0	0.0	0.0	43.5	6.6	e

INR CoaguChek

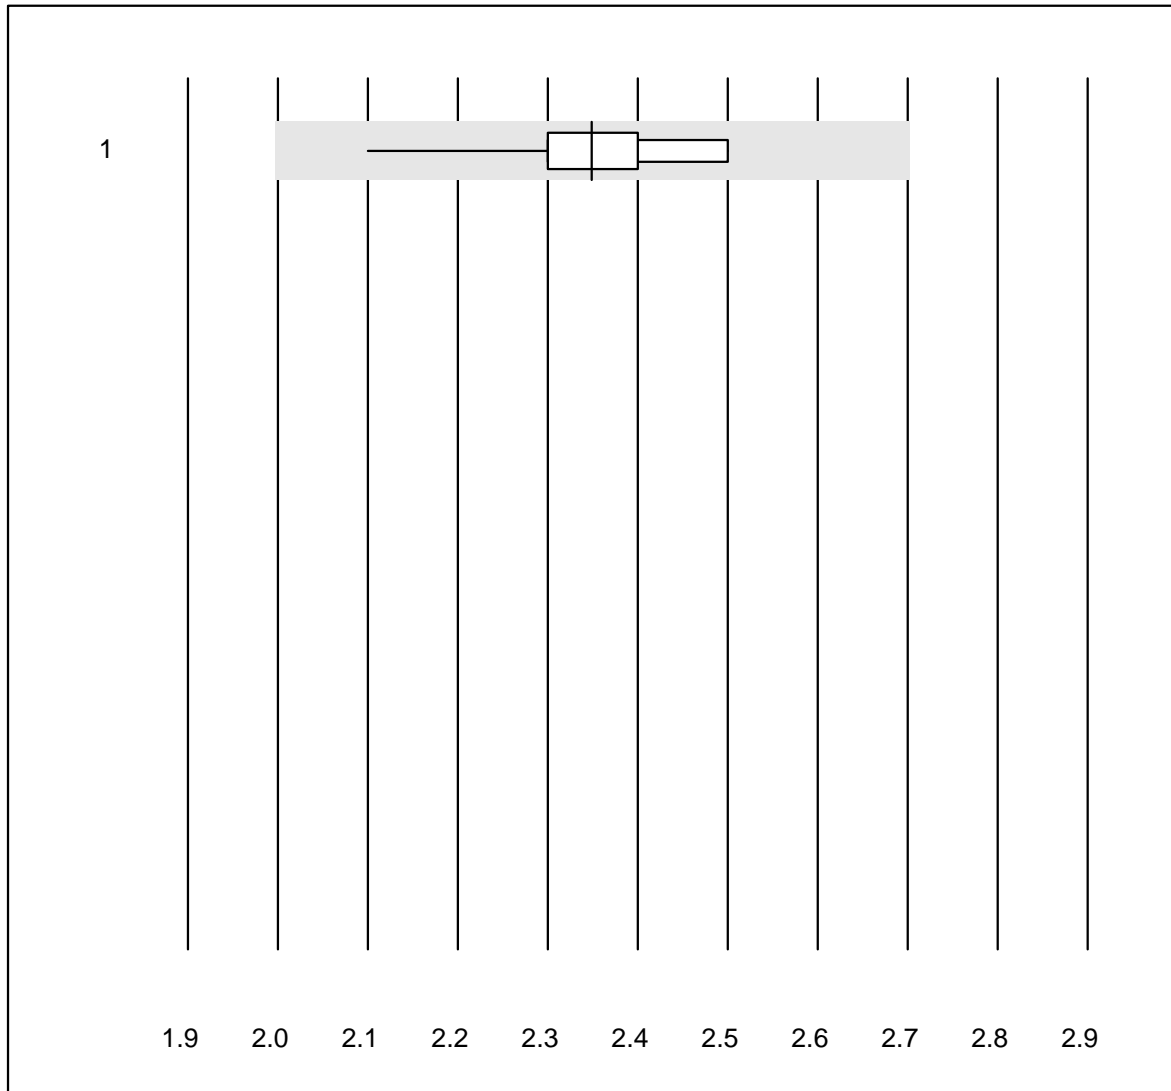


Tolérance QUALAB : 15 %

INR CoaguChek ()


No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 CoaguChek Pro II	148	100.0	0.0	0.0	2.3	3.5	e

Quick N

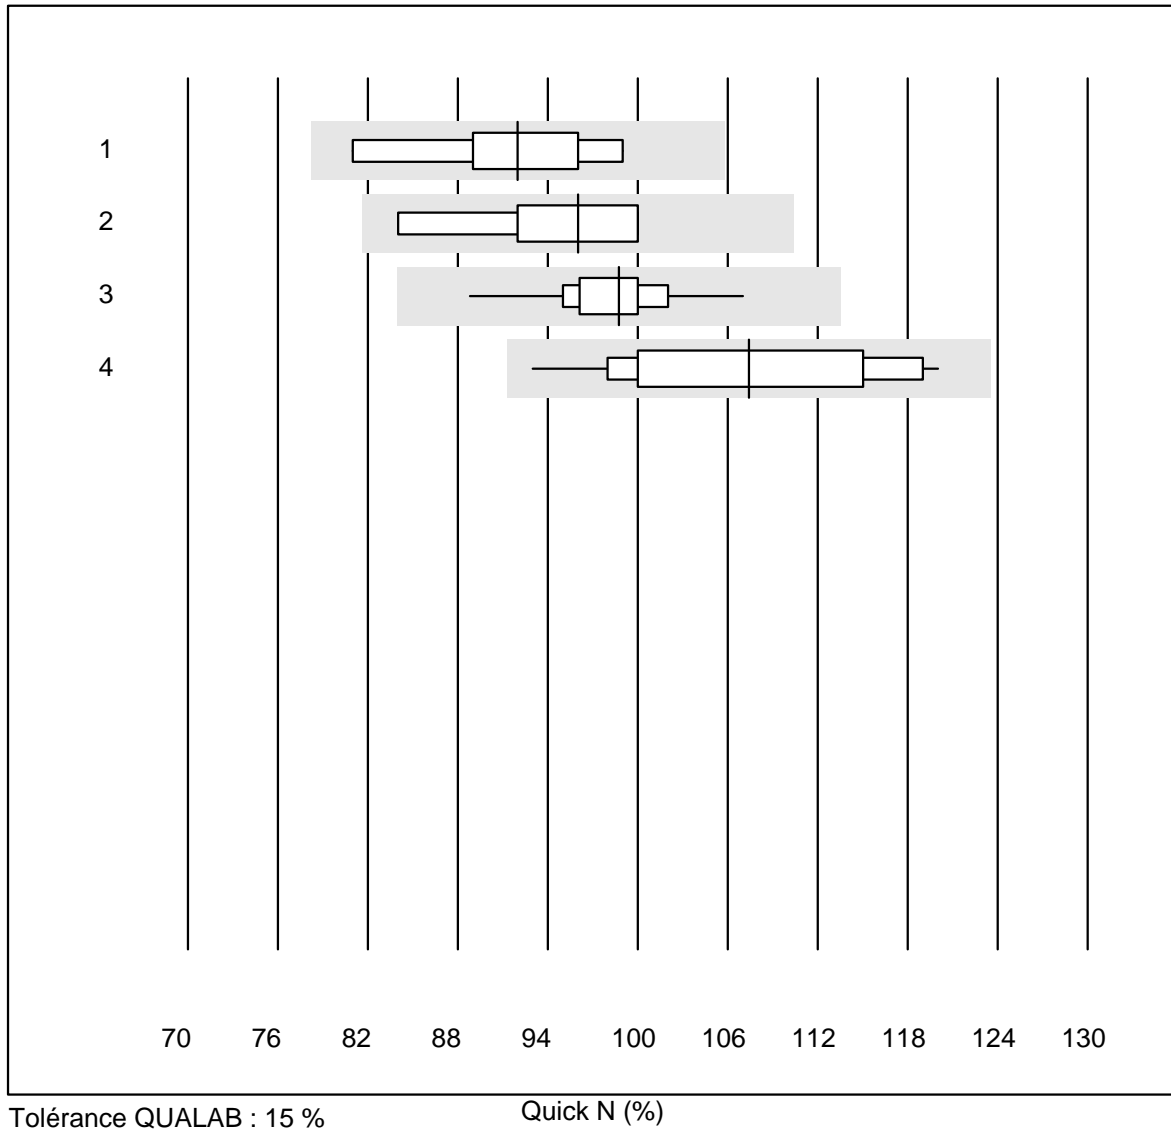


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Neoplastin R	7	100.0	0.0	0.0	92	6.3	e*
2 Neoplastin Plus	5	100.0	0.0	0.0	96	7.1	e*
3 Innovin	12	100.0	0.0	0.0	99	4.4	e
4 Recombiplastin 2G	17	100.0	0.0	0.0	107	8.5	e*

Fibrinogen N

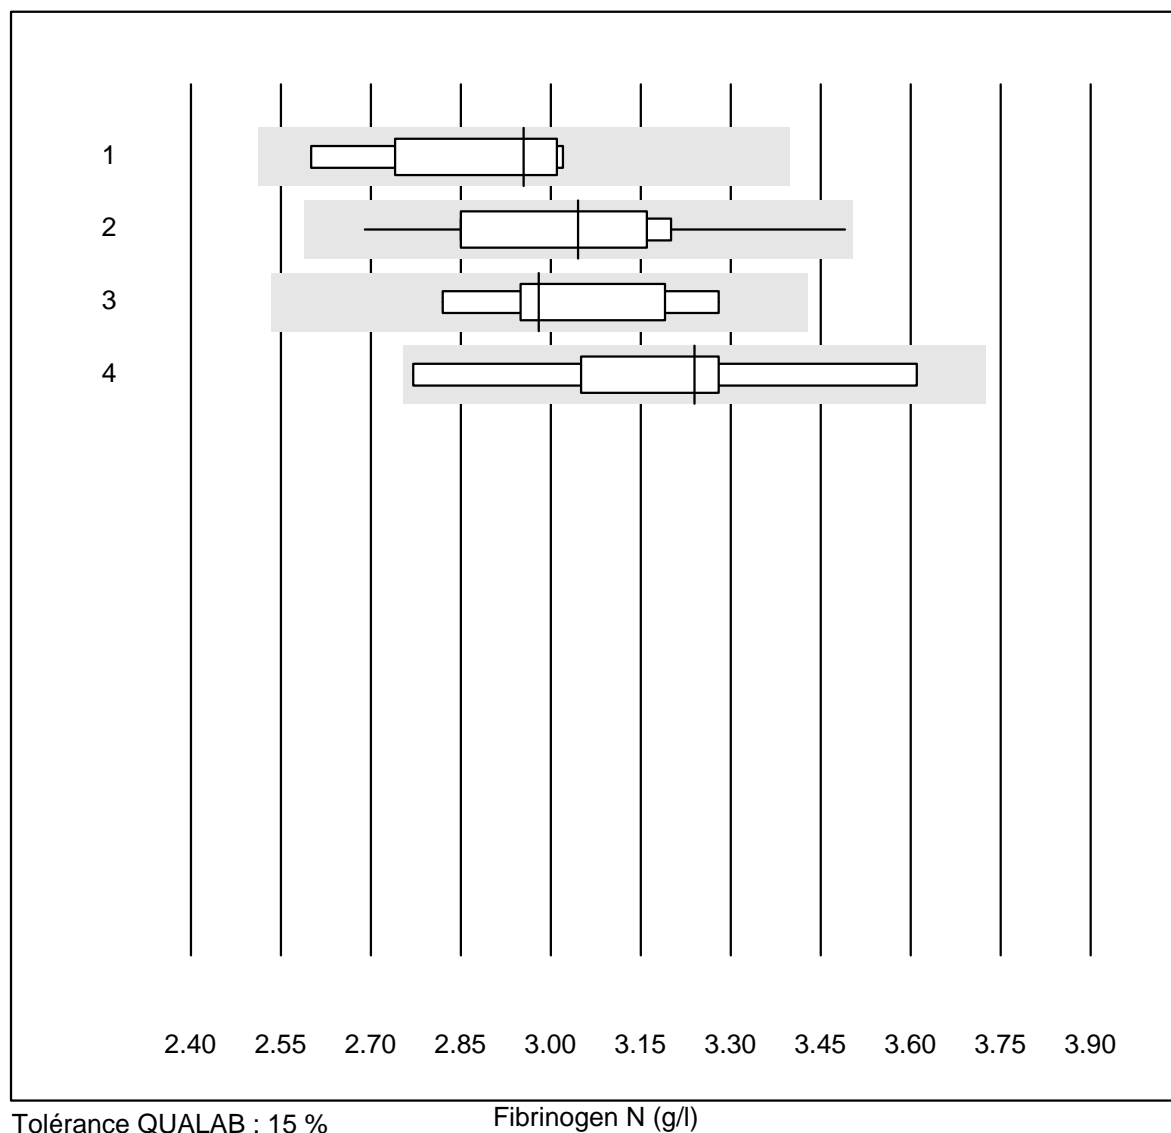


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Siemens Thrombin	6	100.0	0.0	0.0	2.96	6.0	e*
2	Stago/STA	12	100.0	0.0	0.0	3.05	6.8	e*
3	Fibrinogen Q.F.A.	7	100.0	0.0	0.0	2.98	5.1	e*
4	Fib Clauss (IL)	7	100.0	0.0	0.0	3.24	8.2	e*

aPTT N

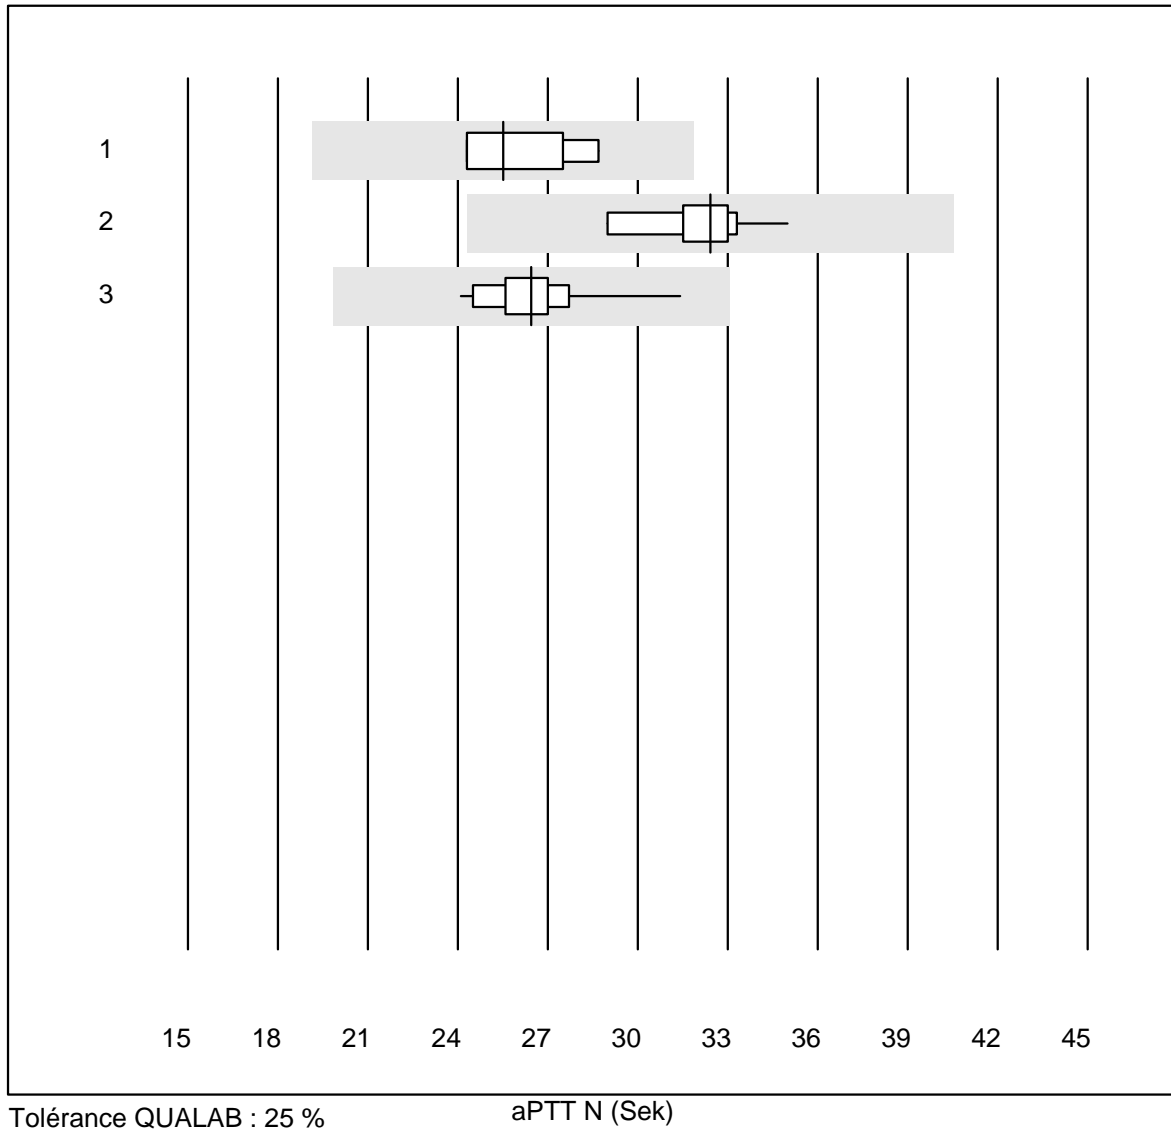


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Actin FS	7	100.0	0.0	0.0	25.5	6.4	e
2 Stago/STA	10	100.0	0.0	0.0	32.4	4.9	e
3 aPTT-SP	15	100.0	0.0	0.0	26.4	6.4	e

Quick H

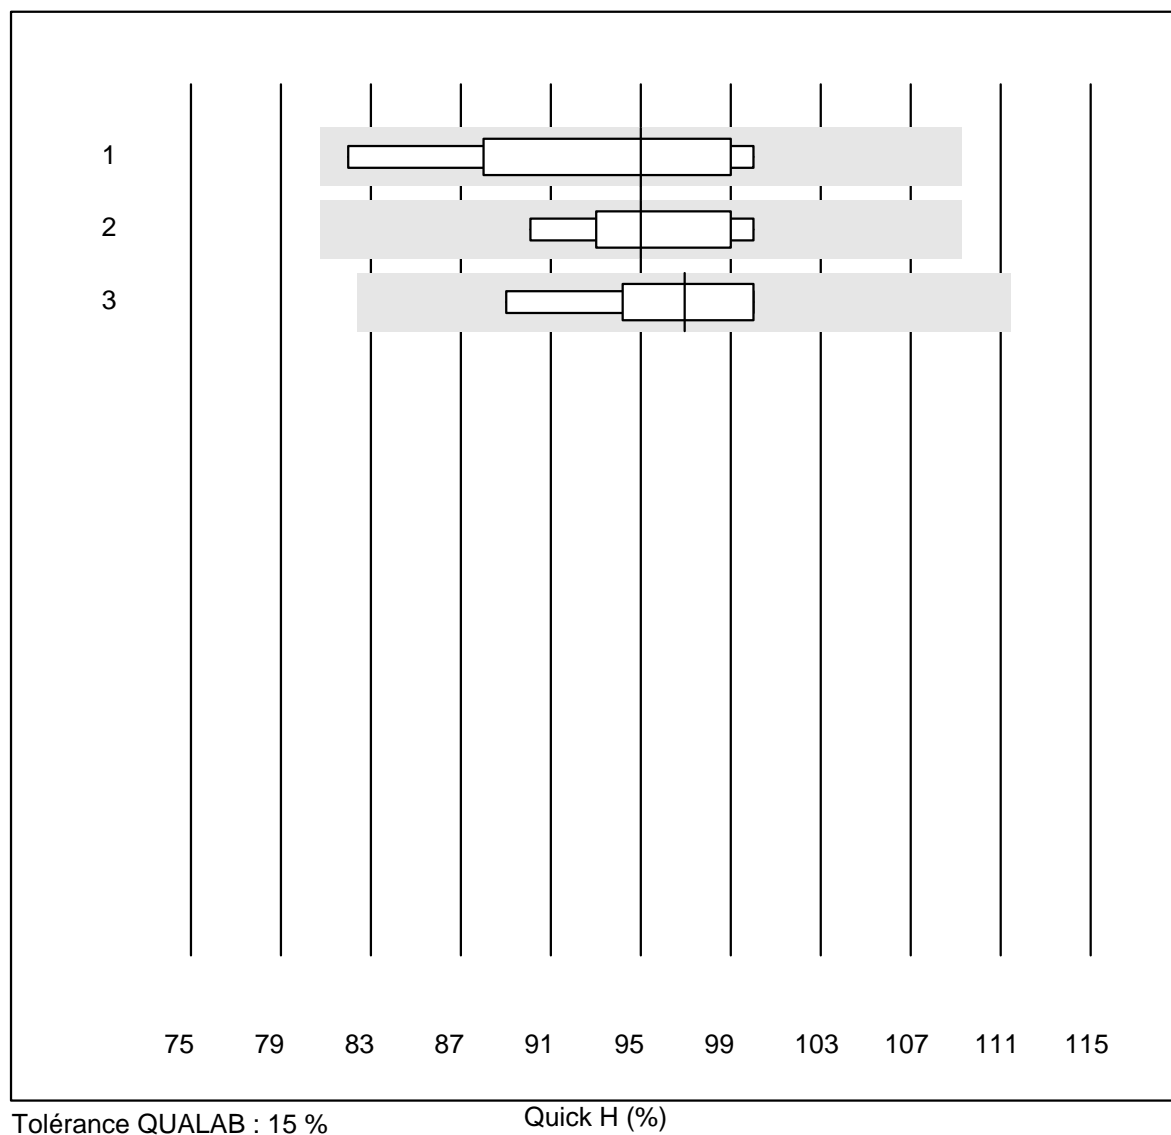


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Neoplastin R	7	100.0	0.0	0.0	95	6.8	e*
2 Innovin	9	100.0	0.0	0.0	95	3.9	e
3 Recombiplastin 2G	10	100.0	0.0	0.0	97	4.0	e

Fibrinogen H

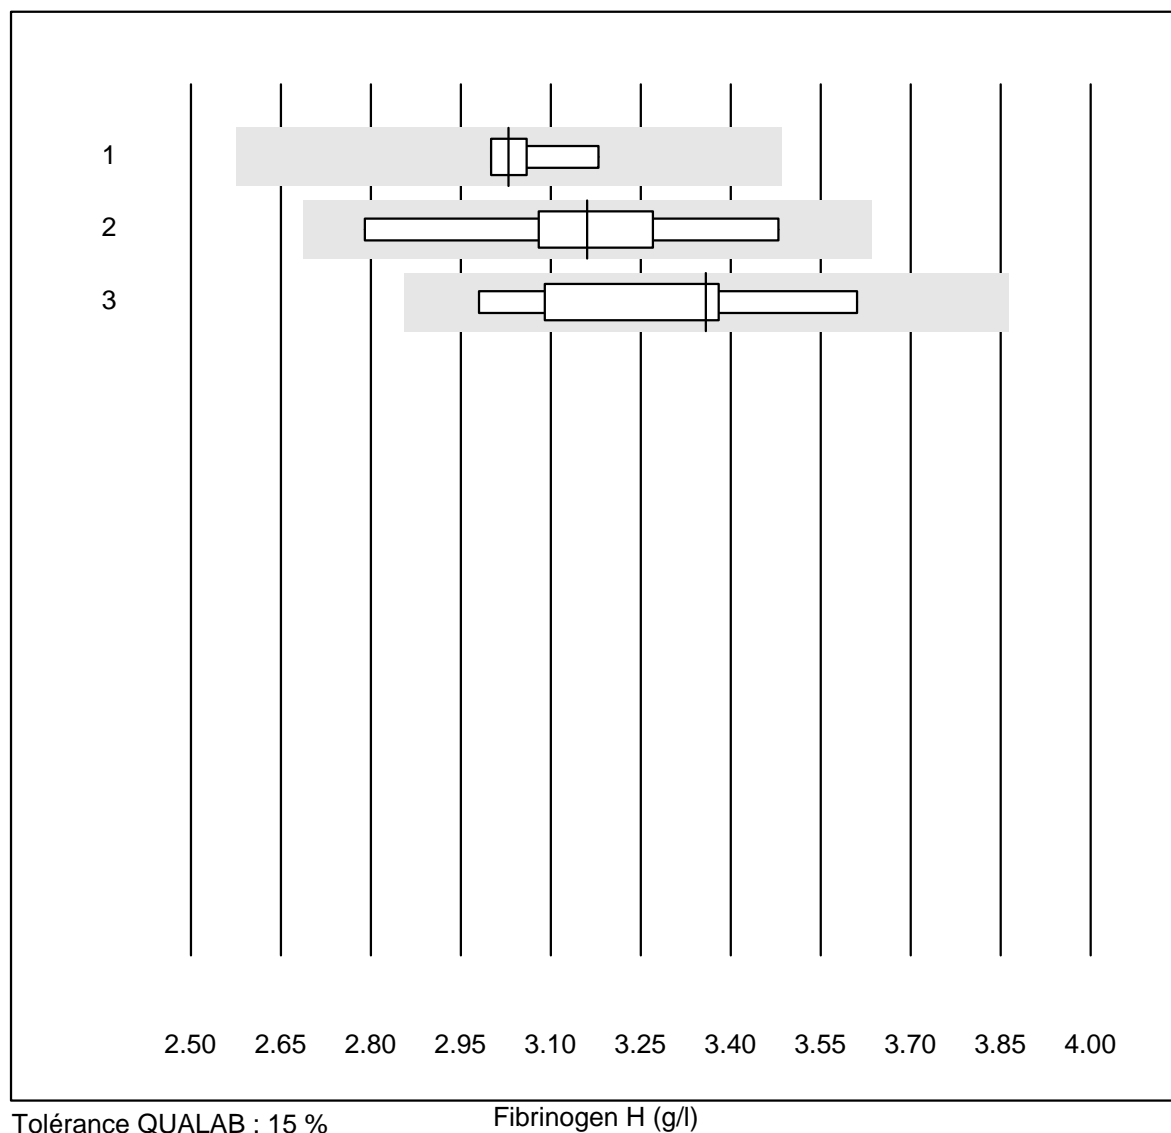

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Siemens Thrombin	4	100.0	0.0	0.0	3.03	2.8	e
2	Stago/STA	9	100.0	0.0	0.0	3.16	7.6	e*
3	Fib Clauss (IL)	5	100.0	0.0	0.0	3.36	7.6	e*

aPTT H

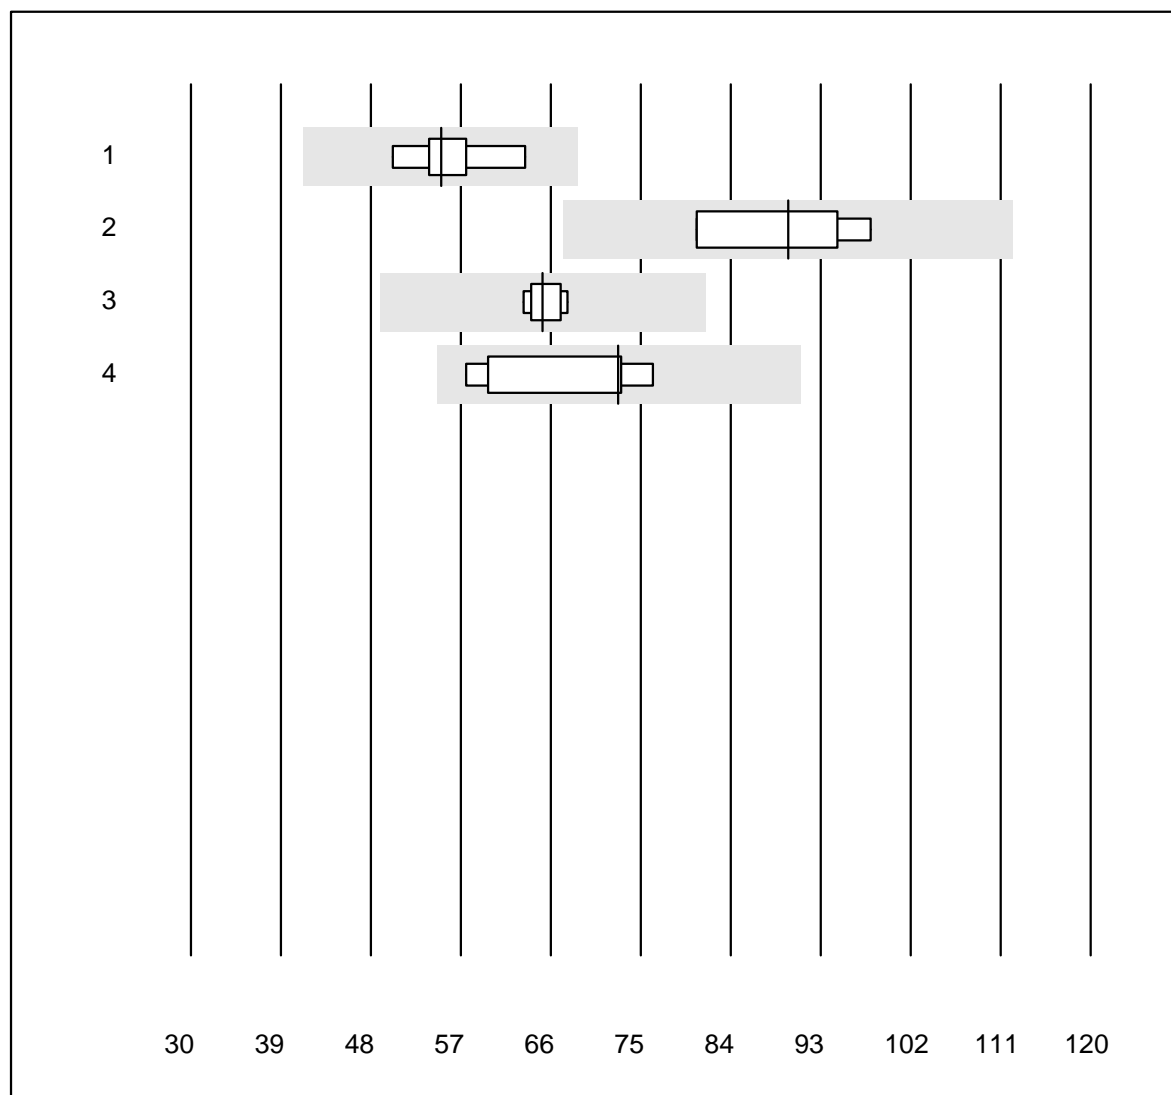


Tolérance QUALAB : 25 %

aPTT H (Sek)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Actin FS	8	100.0	0.0	0.0	55.0	7.4	e
2 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	89.8	9.1	e*
3 Stago/STA	5	100.0	0.0	0.0	65.2	2.9	e
4 aPTT-SP	7	100.0	0.0	0.0	72.8	10.6	e*

D-Dimères NC

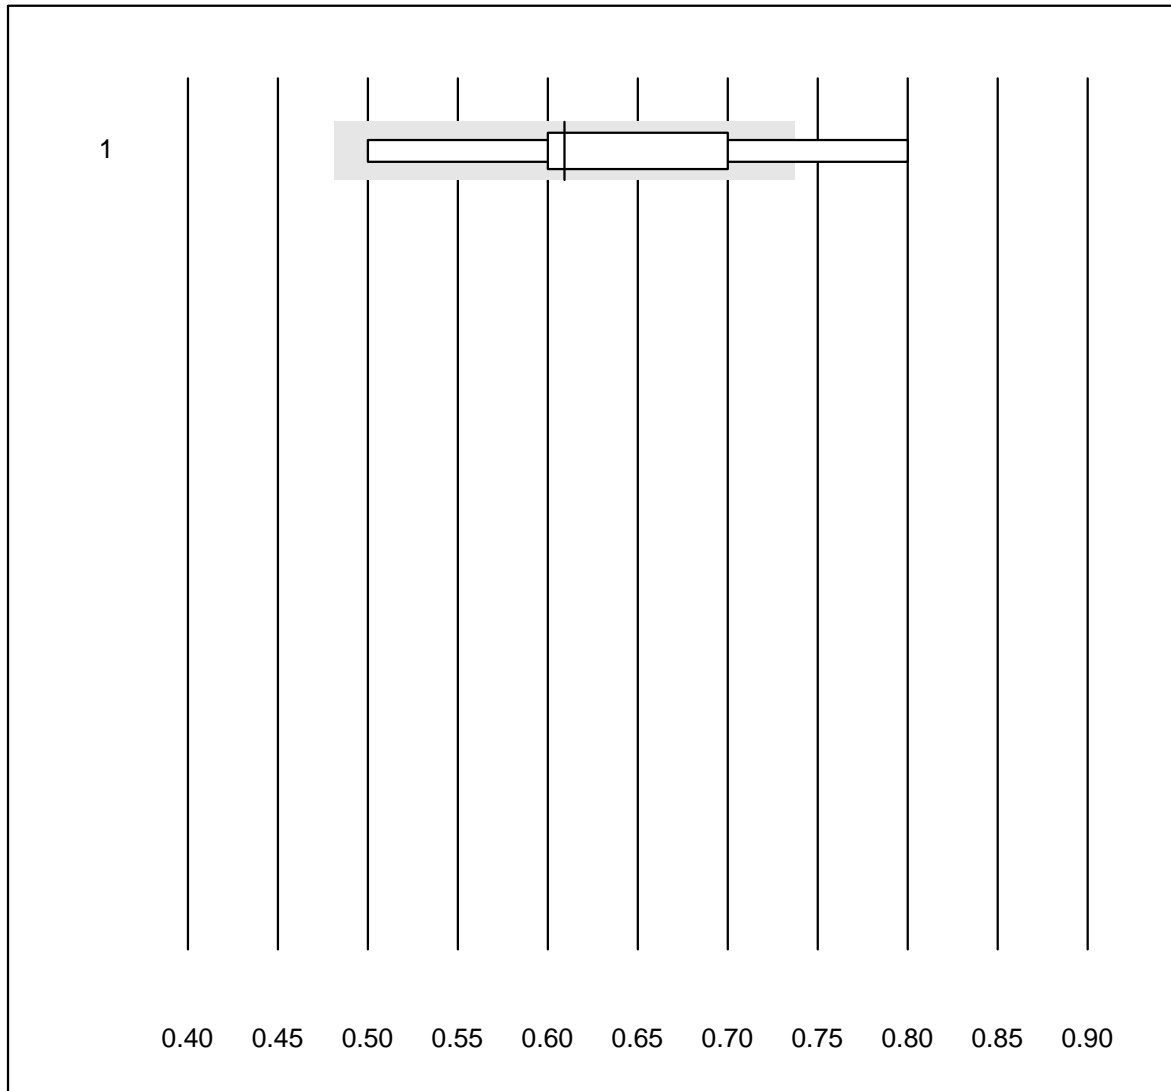


Tolérance QUALAB : 21 %

D-Dimères NC (mg/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 NycoCard	18	61.1	11.1	27.8	0.61	15.0	e*

D-Dimères

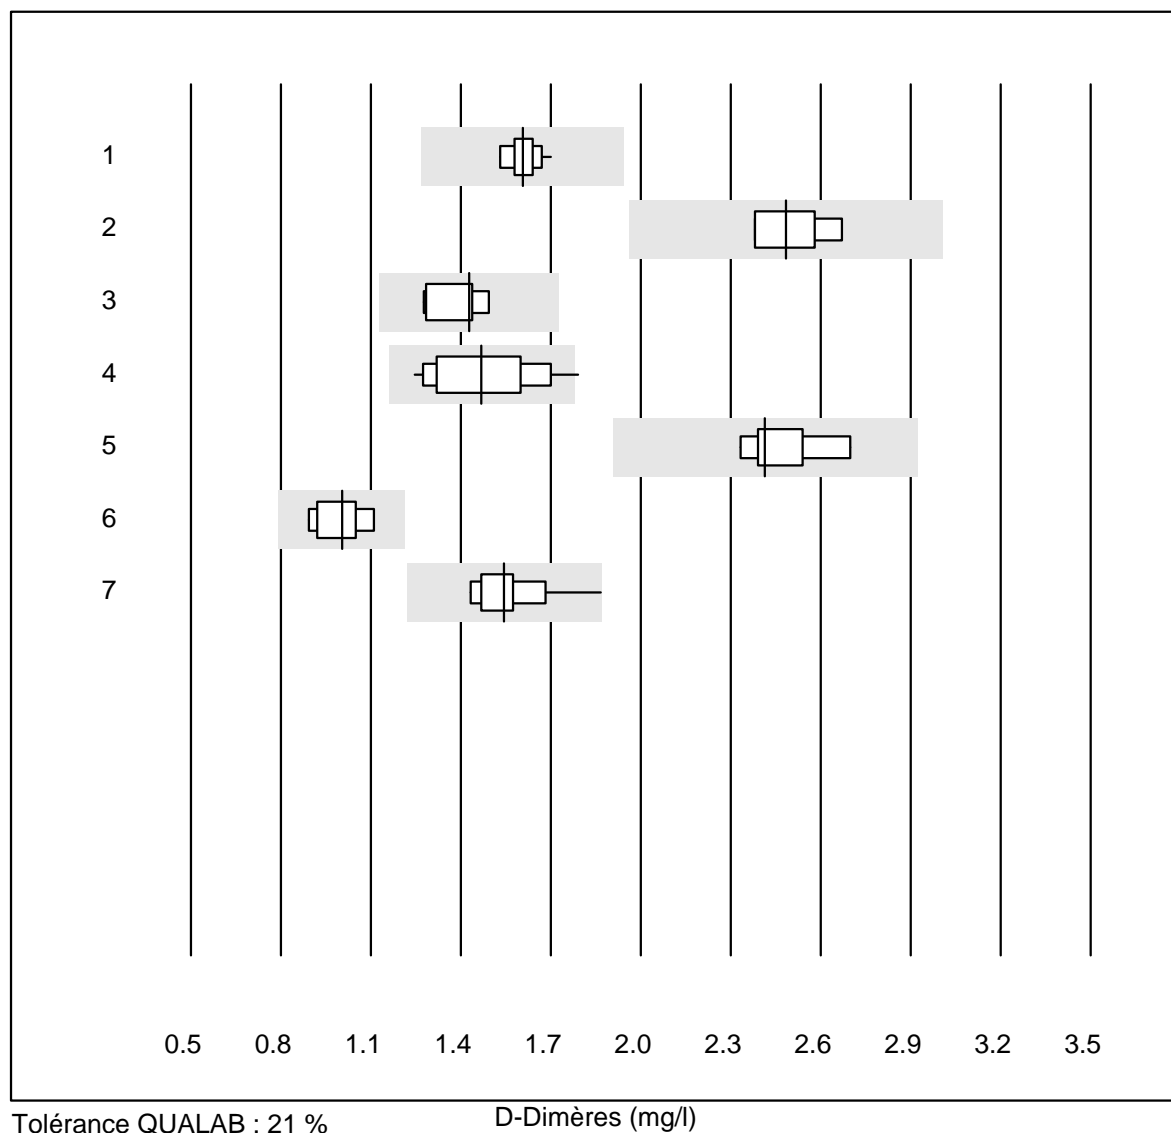


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 STA Liatest	10	100.0	0.0	0.0	1.61	3.2	e
2 Siemens Innovance	4	100.0	0.0	0.0	2.49	5.7	e*
3 Eurolyser (Cutoff 0.	5	100.0	0.0	0.0	1.43	7.0	e*
4 Eurolyser	23	74.0	4.3	21.7	1.47	11.4	e
5 ACL	6	100.0	0.0	0.0	2.41	5.4	e
6 AQT 90 FLEX	8	100.0	0.0	0.0	1.00	8.0	e*
7 VIDAS	18	100.0	0.0	0.0	1.54	7.0	e

INR CCXS

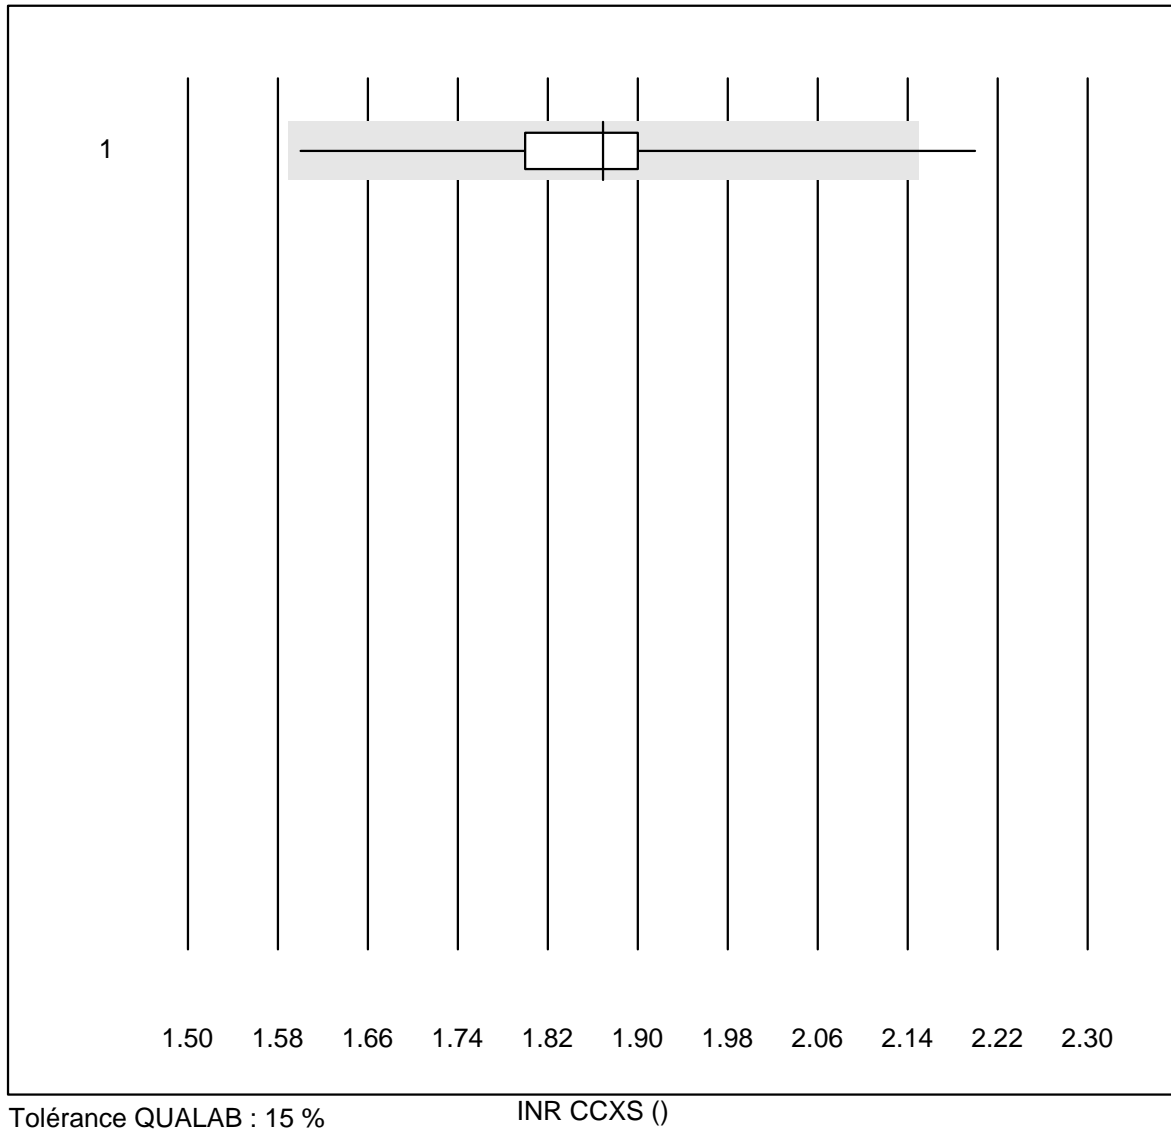


No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 CoaguChek XS	2227	96.1	3.0	0.9	1.9	5.2	e

INR HC

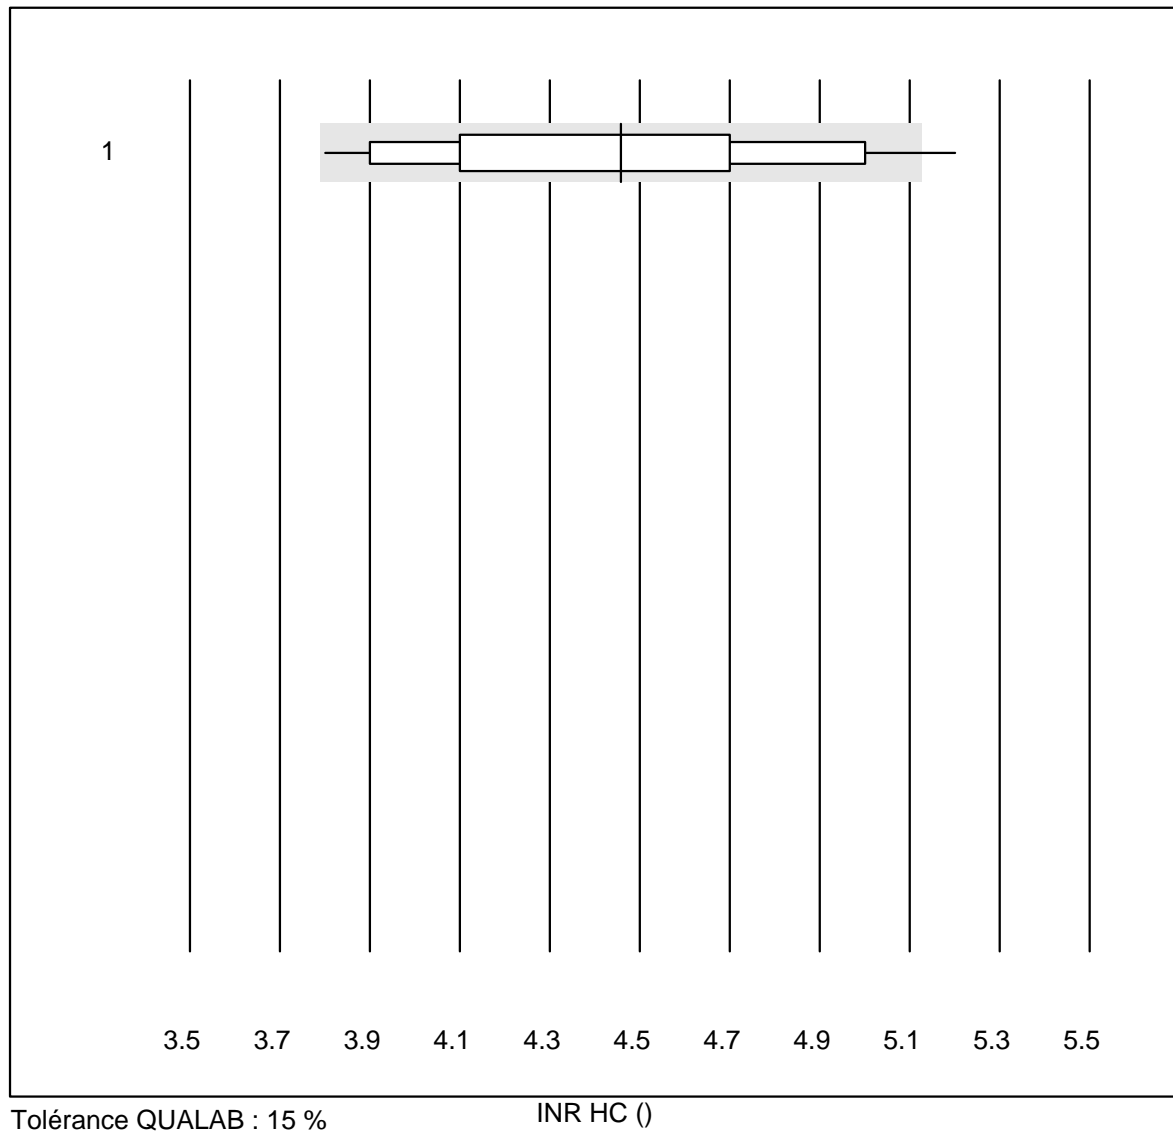


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Hemochron j.	13	84.6	7.7	7.7	4.5	9.7	e*

INR MI

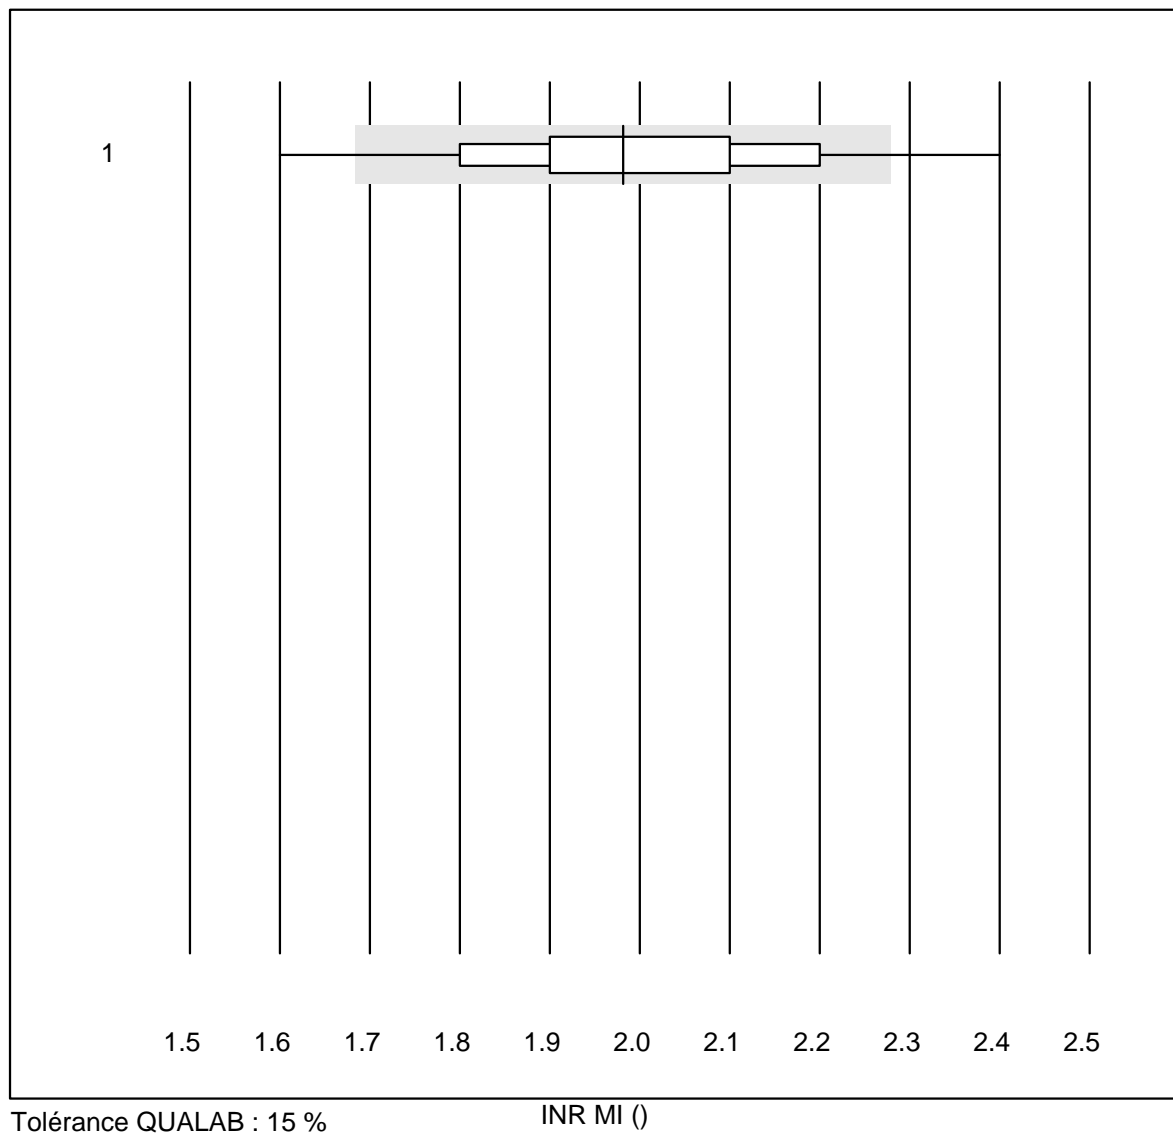

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 MicroINR	93	87.1	7.5	5.4	2.0	8.1	e

INR Xprecia

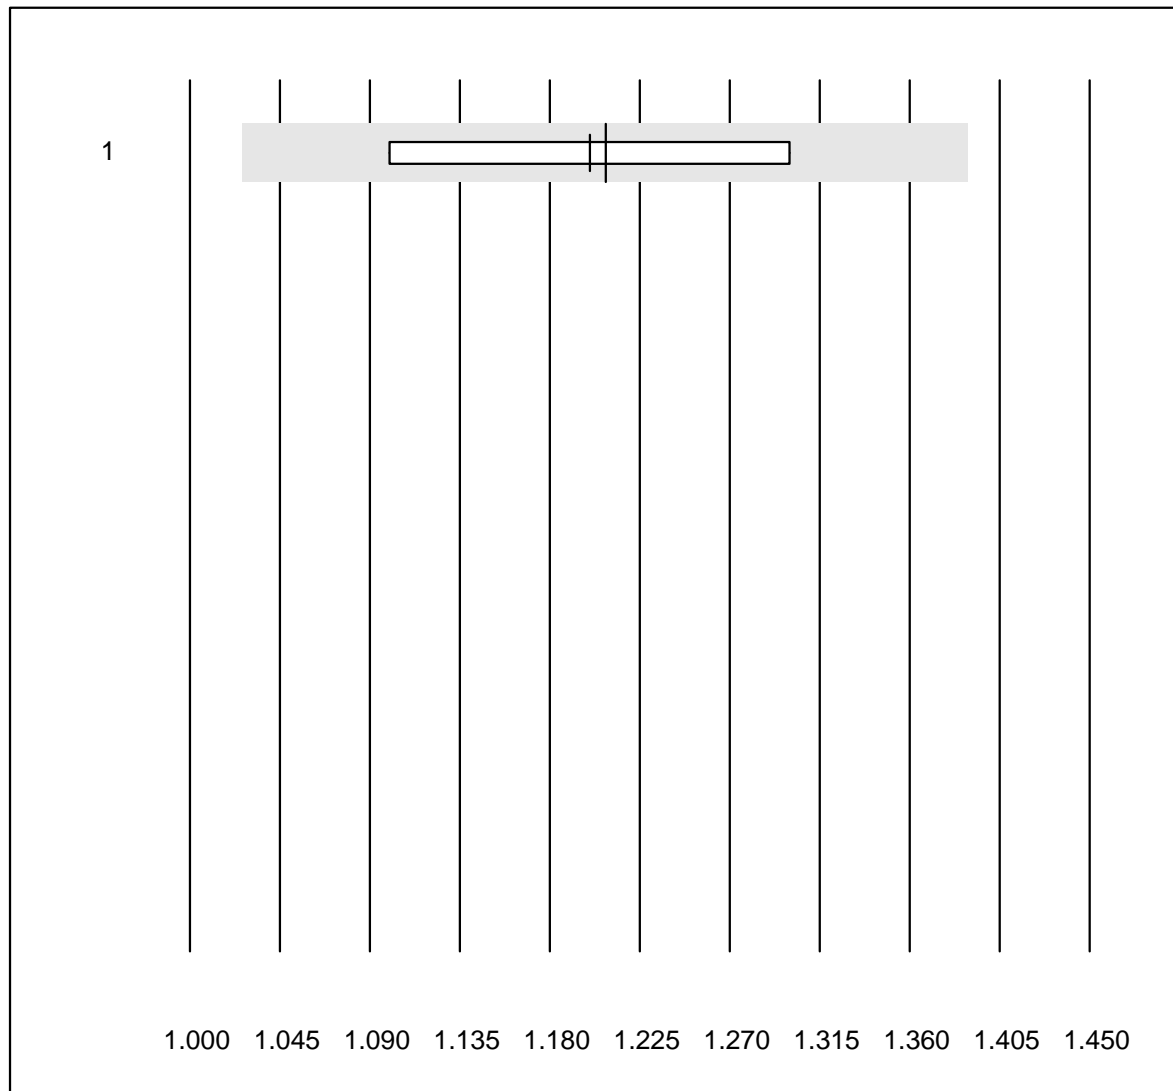


Tolérance QUALAB : 15 %

INR Xprecia ()


No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Xprecia	52	100.0	0.0	0.0	1.2	5.0	e

Hémoglobine

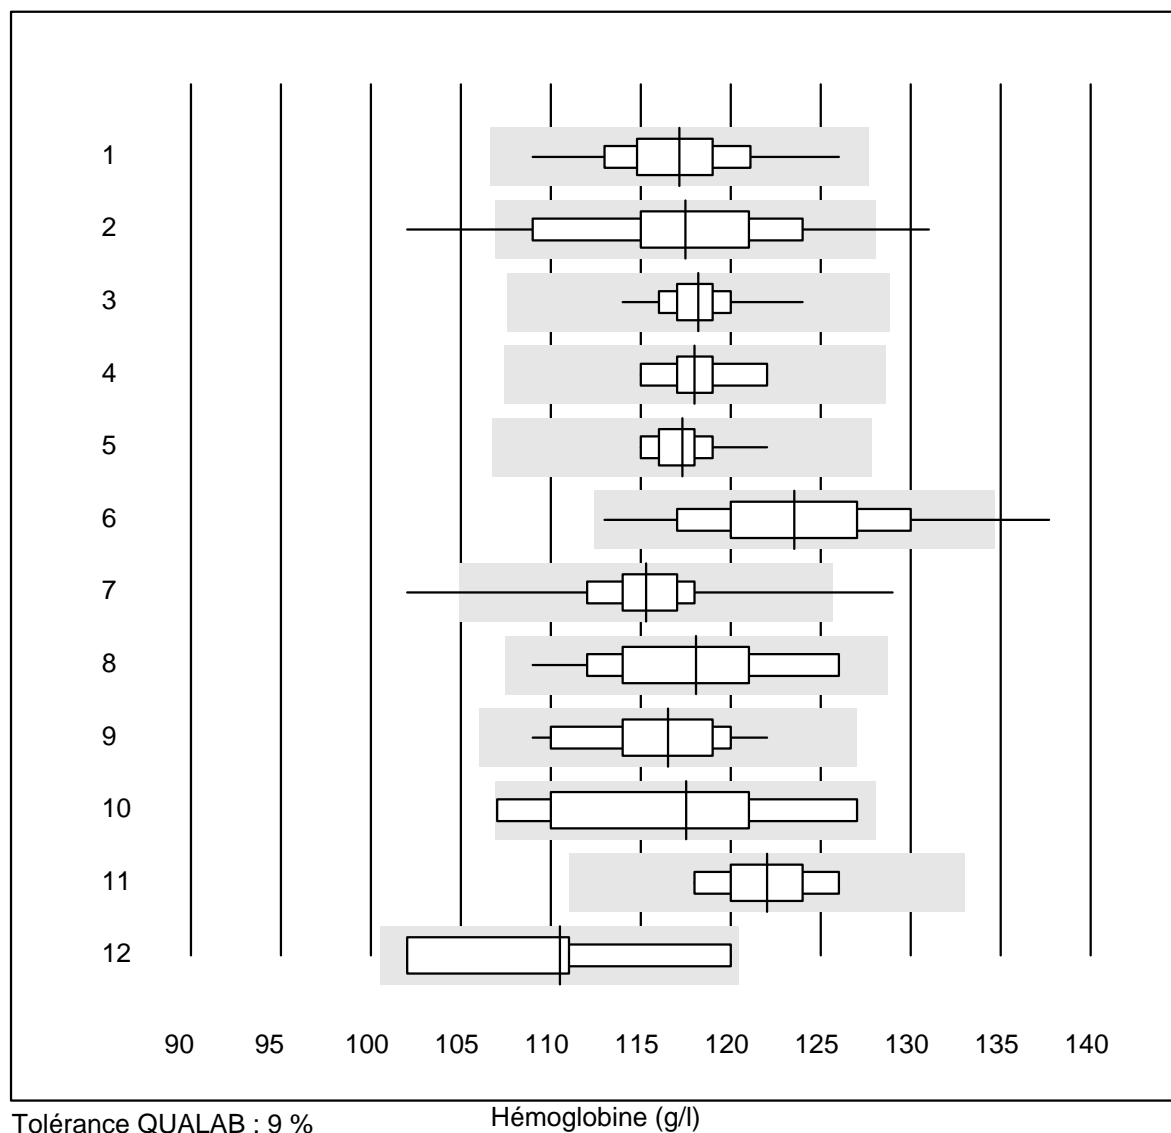


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Automate	32	100.0	0.0	0.0	117.1	3.0	e
2	Cyanmethémoglobine	38	92.1	7.9	0.0	117.5	4.8	e
3	System X	41	100.0	0.0	0.0	118.2	1.6	e
4	Advia 120	9	100.0	0.0	0.0	118.0	1.8	e
5	ABX Pentra	11	100.0	0.0	0.0	117.3	1.7	e
6	Reflotron	60	95.0	5.0	0.0	123.5	4.3	e
7	Hemocue	360	95.3	1.4	3.3	115.3	2.5	e
8	Dr. Lange	18	88.9	0.0	11.1	118.1	4.1	e
9	Hemocontrol	14	100.0	0.0	0.0	116.5	3.3	e
10	Eurolyser	6	100.0	0.0	0.0	117.5	6.2	e*
11	DiaSpect	9	100.0	0.0	0.0	122.0	2.1	e
12	MS4	4	100.0	0.0	0.0	110.5	6.7	e*

Hémoglobine

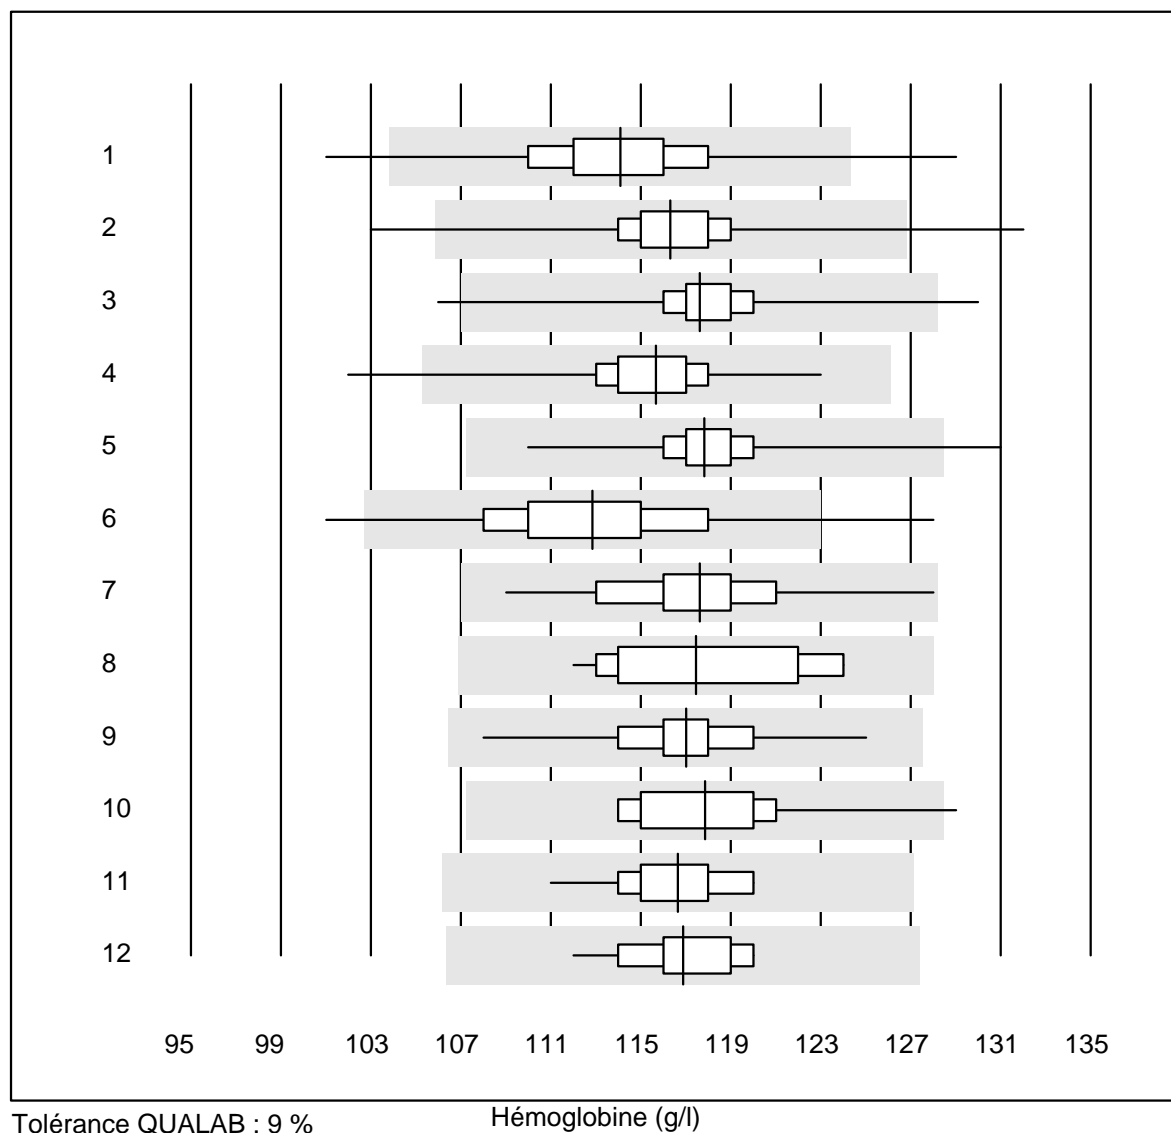

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Abx Micros	607	96.5	1.0	2.5	114.1	3.0	e
2	Microsemi	492	97.2	1.0	1.8	116.3	2.2	e
3	Sysmex KX21	355	96.9	0.6	2.5	117.6	1.8	e
4	Sysmex PochH - 100i	206	96.6	0.5	2.9	115.7	2.1	e
5	Sysmex XP 300	349	95.1	0.3	4.6	117.8	1.7	e
6	Mythic	249	94.8	2.4	2.8	112.9	3.7	e
7	Swelab	67	98.5	0.0	1.5	117.6	2.6	e
8	Abacus Junior	11	100.0	0.0	0.0	117.5	3.7	e*
9	Medonic	14	100.0	0.0	0.0	117.0	3.2	e
10	Nihon Kohden Celltac	46	93.5	2.2	4.3	117.9	2.6	e
11	Samsung HC10	45	100.0	0.0	0.0	116.6	2.0	e
12	Norma Icon 3	20	90.0	0.0	10.0	116.9	1.9	e

Hématocrite

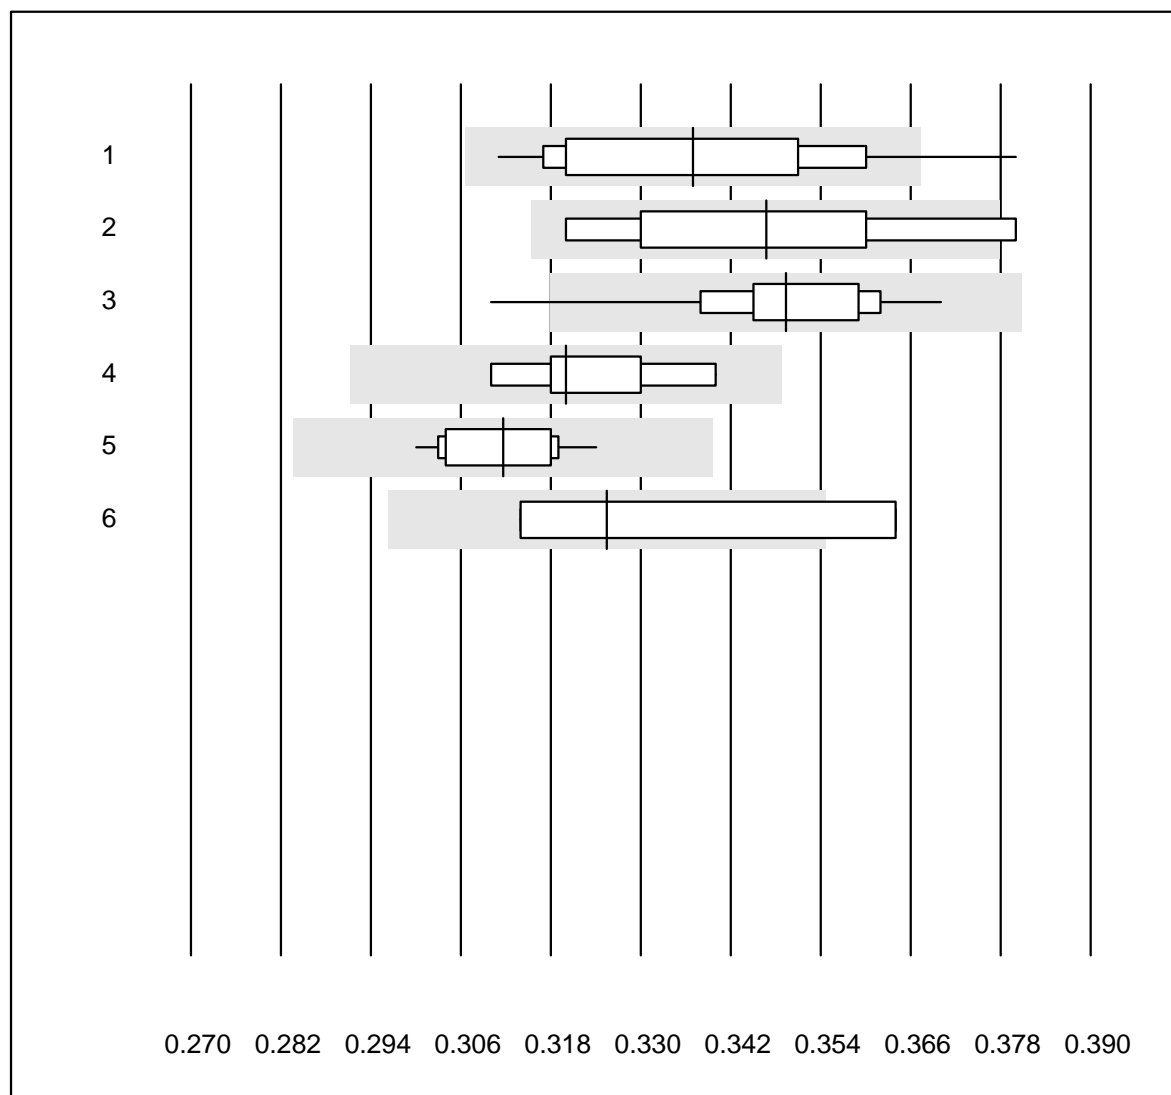


Tolérance QUALAB : 9 %

Hématocrite (l/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Automate	26	92.3	7.7	0.0	0.34	5.5	e
2	Centrifuge	12	83.3	16.7	0.0	0.35	6.2	e*
3	Sysmex X	41	97.6	2.4	0.0	0.35	3.2	e
4	Advia 120	9	100.0	0.0	0.0	0.32	2.7	e
5	ABX Pentra	11	100.0	0.0	0.0	0.31	2.5	e
6	MS4	4	50.0	25.0	25.0	0.33	7.4	e*

Hématocrite

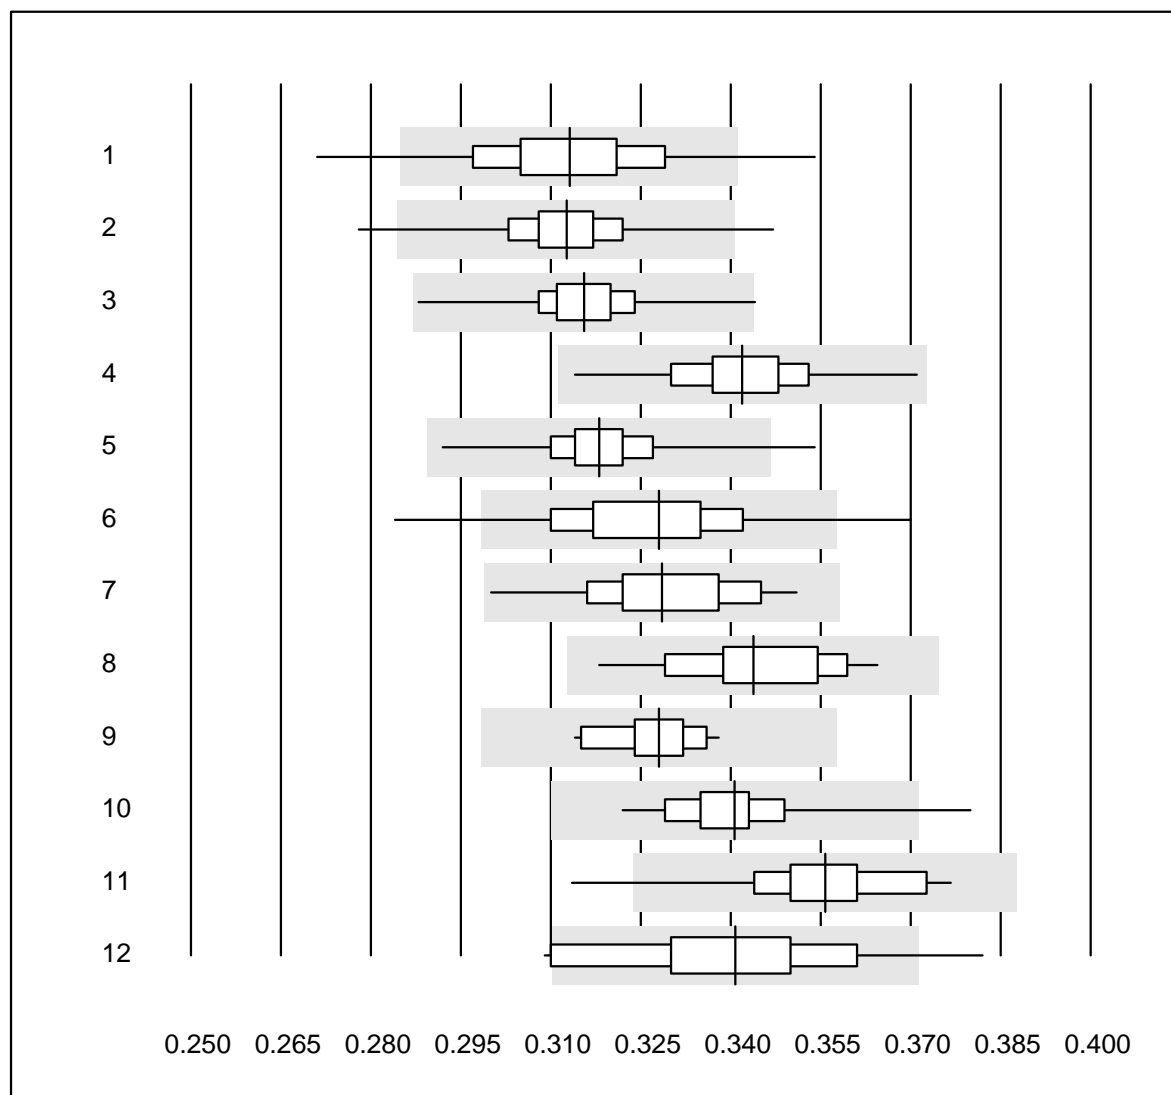


Tolérance QUALAB : 9 %

Hématocrite (l/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Abx Micros	607	94.9	2.0	3.1	0.31	4.0	e
2 Microsemi	490	97.8	0.6	1.6	0.31	2.5	e
3 Sysmex KX21	355	97.7	0.3	2.0	0.32	2.2	e
4 Sysmex PochH - 100i	206	98.1	0.0	1.9	0.34	2.9	e
5 Sysmex XP 300	344	97.1	0.3	2.6	0.32	2.2	e
6 Mythic	249	94.4	2.8	2.8	0.33	4.0	e
7 Swelab	67	100.0	0.0	0.0	0.33	3.5	e
8 Abacus Junior	11	100.0	0.0	0.0	0.34	3.8	e*
9 Medonic	14	92.9	0.0	7.1	0.33	2.4	e
10 Nihon Kohden Celltac	46	91.4	4.3	4.3	0.34	3.3	e
11 Samsung HC10	45	97.8	2.2	0.0	0.36	3.4	e
12 Norma Icon 3	20	75.0	15.0	10.0	0.34	5.5	e*

Erythrocytes

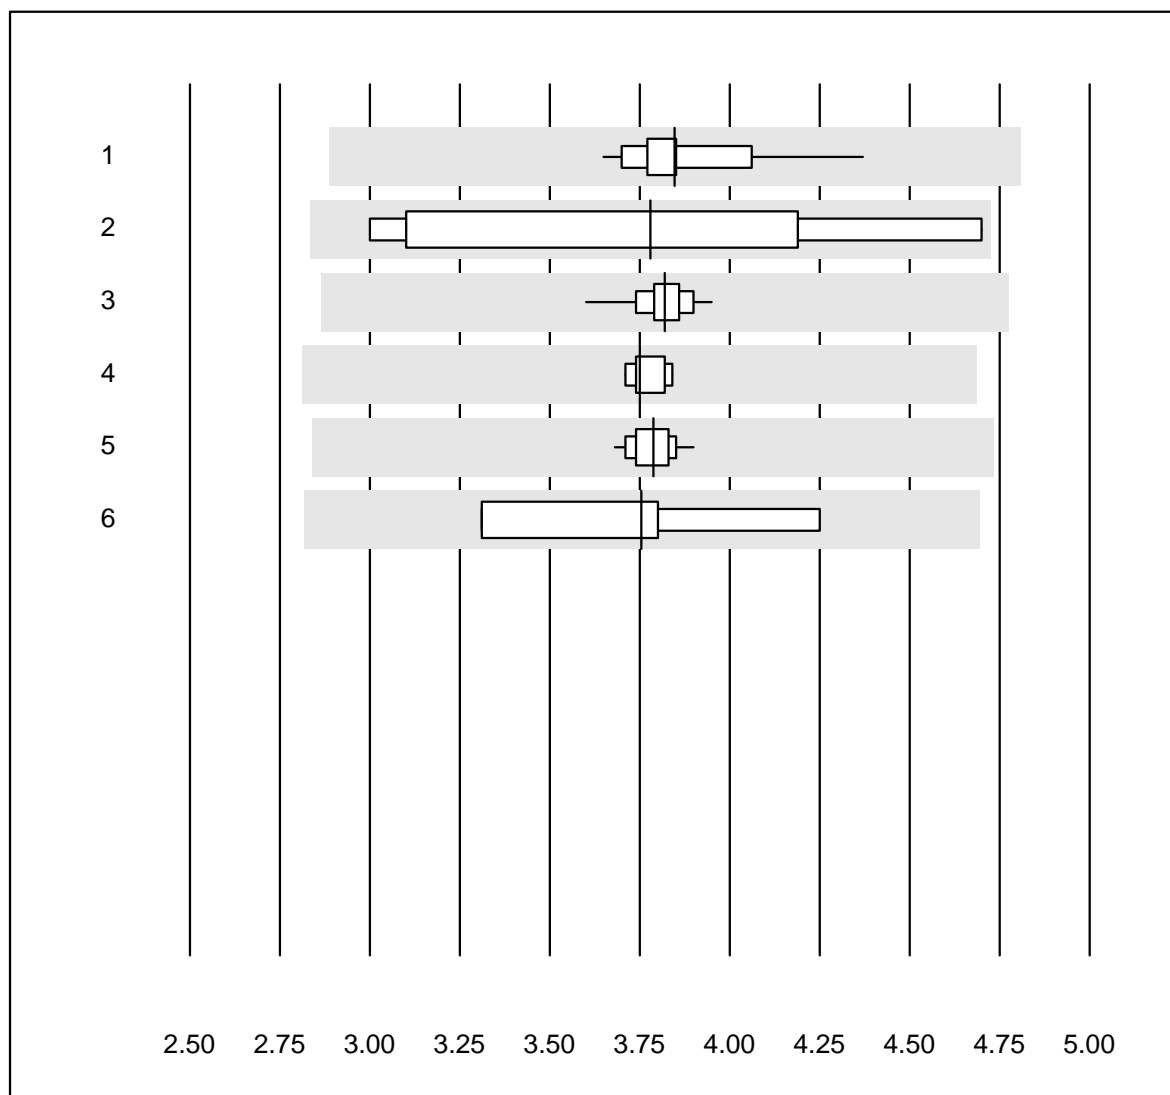


Tolérance QUALAB : 25 %

Erythrocytes (T/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Automate	25	100.0	0.0	0.0	3.85	4.2	e
2	Microscopie	7	100.0	0.0	0.0	3.78	17.5	a
3	Sysmex X	42	100.0	0.0	0.0	3.82	1.8	e
4	Advia 120	9	100.0	0.0	0.0	3.75	1.4	e
5	ABX Pentra	11	100.0	0.0	0.0	3.79	1.7	e
6	MS4	4	100.0	0.0	0.0	3.76	10.2	e*

Erythrocytes

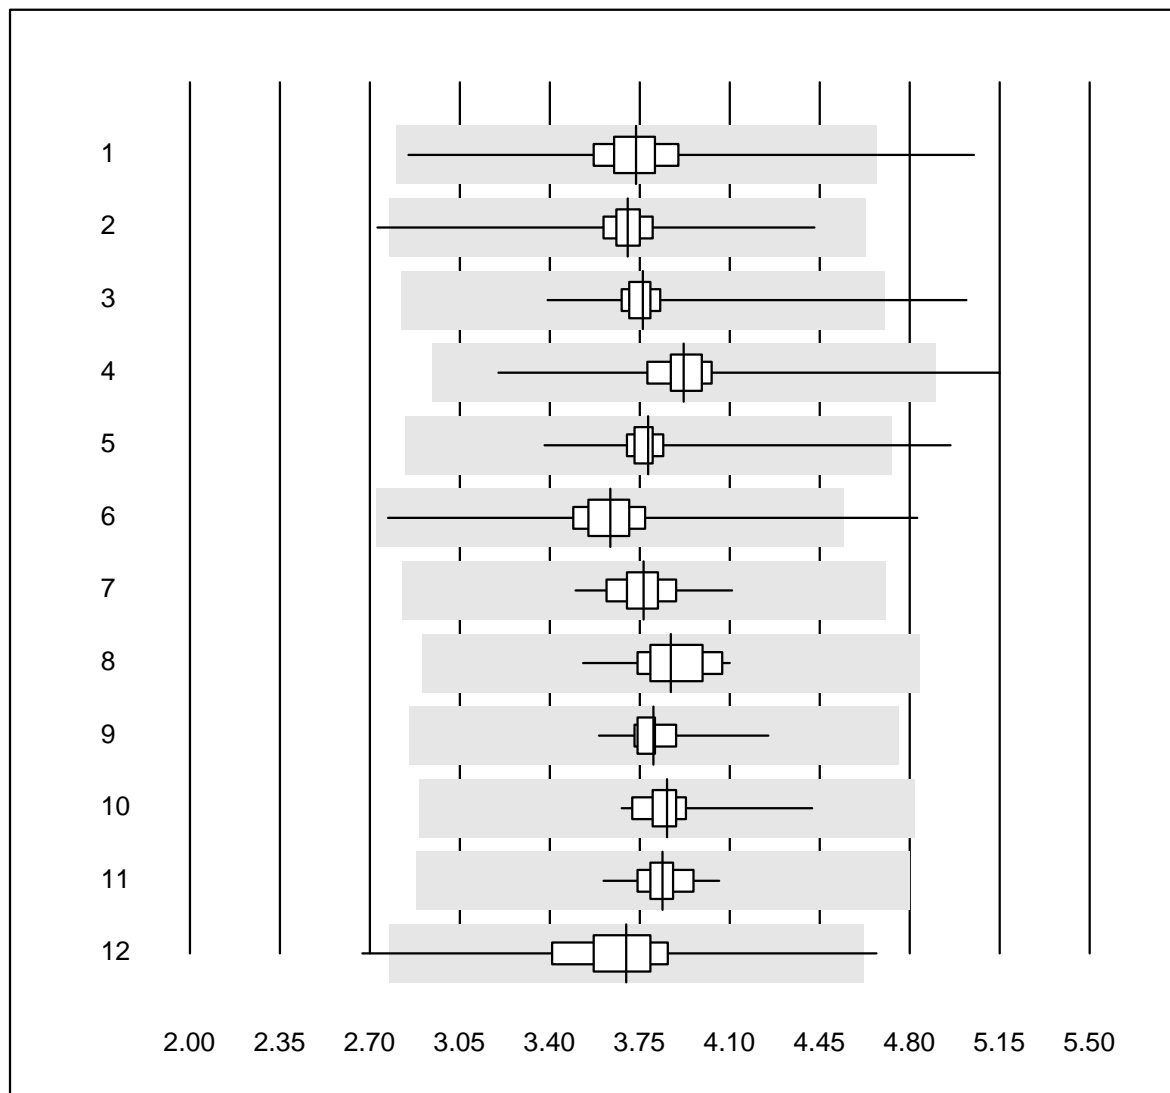


Tolérance QUALAB : 25 %

Erythrocytes (T/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Abx Micros	607	98.3	0.2	1.5	3.74	4.4	e
2	Microsemi	491	99.0	0.2	0.8	3.70	3.1	e
3	Sysmex KX21	355	98.6	0.6	0.8	3.76	3.3	e
4	Sysmex PochH - 100i	206	99.5	0.5	0.0	3.92	3.9	e
5	Sysmex XP 300	346	97.9	1.2	0.9	3.78	3.9	e
6	Mythic	248	98.0	0.4	1.6	3.63	4.2	e
7	Swelab	67	100.0	0.0	0.0	3.77	3.0	e
8	Abacus Junior	11	100.0	0.0	0.0	3.87	4.2	e
9	Medonic	14	100.0	0.0	0.0	3.80	3.9	e
10	Nihon Kohden Celltac	46	97.8	0.0	2.2	3.86	3.4	e
11	Samsung HC10	45	100.0	0.0	0.0	3.84	2.2	e
12	Norma Icon 3	20	90.0	10.0	0.0	3.70	9.5	e

Leucocytes

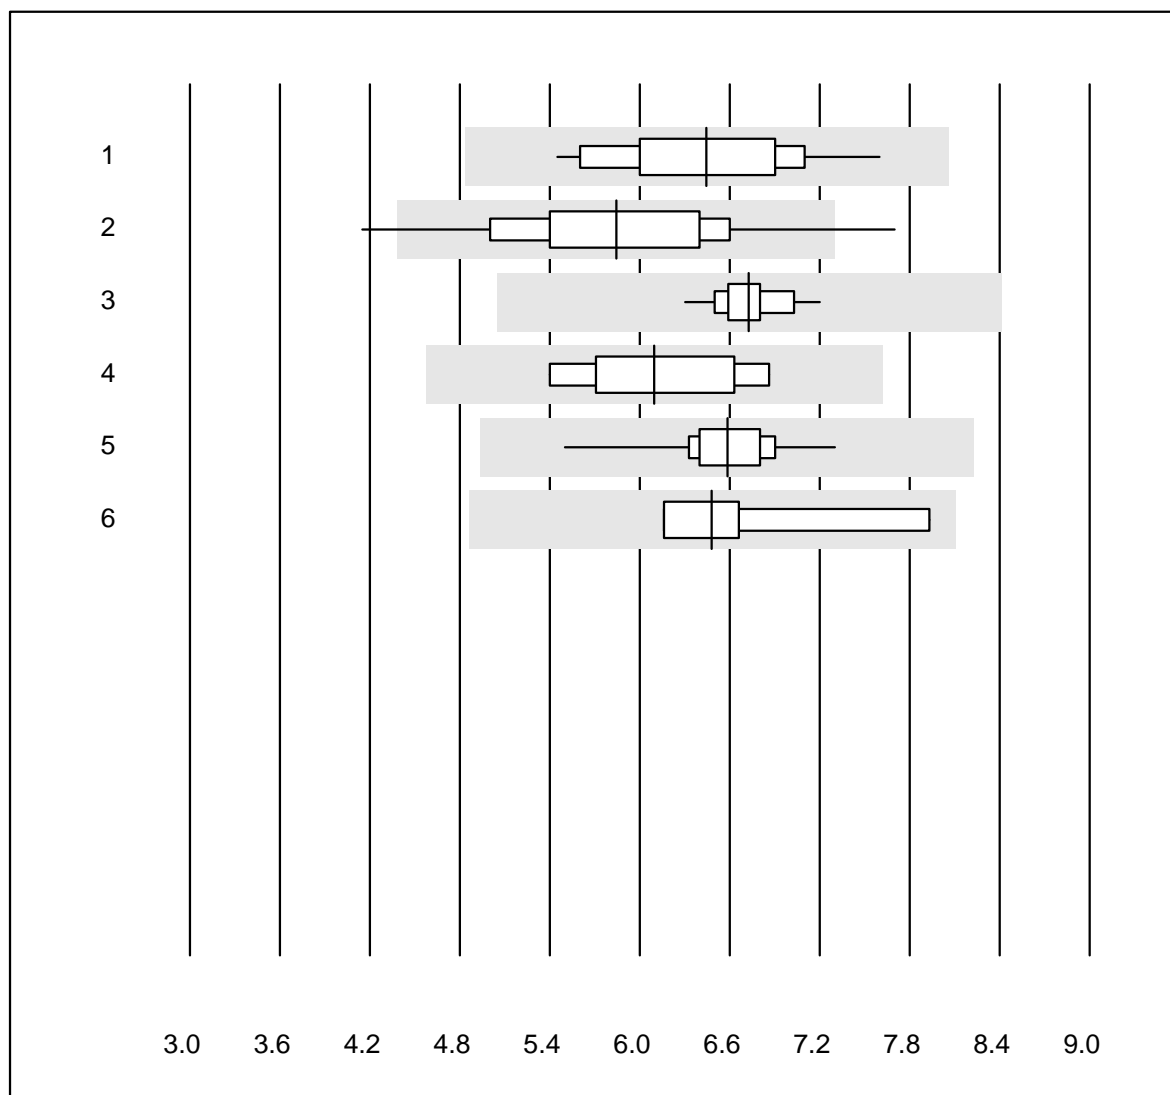


Tolérance QUALAB : 25 %

Leucocytes (G/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Automate	23	100.0	0.0	0.0	6.44	8.5	e
2	Microscopie	39	89.8	5.1	5.1	5.84	12.1	e
3	Sysmex X	42	100.0	0.0	0.0	6.73	3.2	e
4	Advia 120 (Perox)	8	100.0	0.0	0.0	6.10	8.9	e*
5	ABX Pentra	11	100.0	0.0	0.0	6.58	6.8	e
6	MS4	4	100.0	0.0	0.0	6.48	11.9	e*

Leucocytes

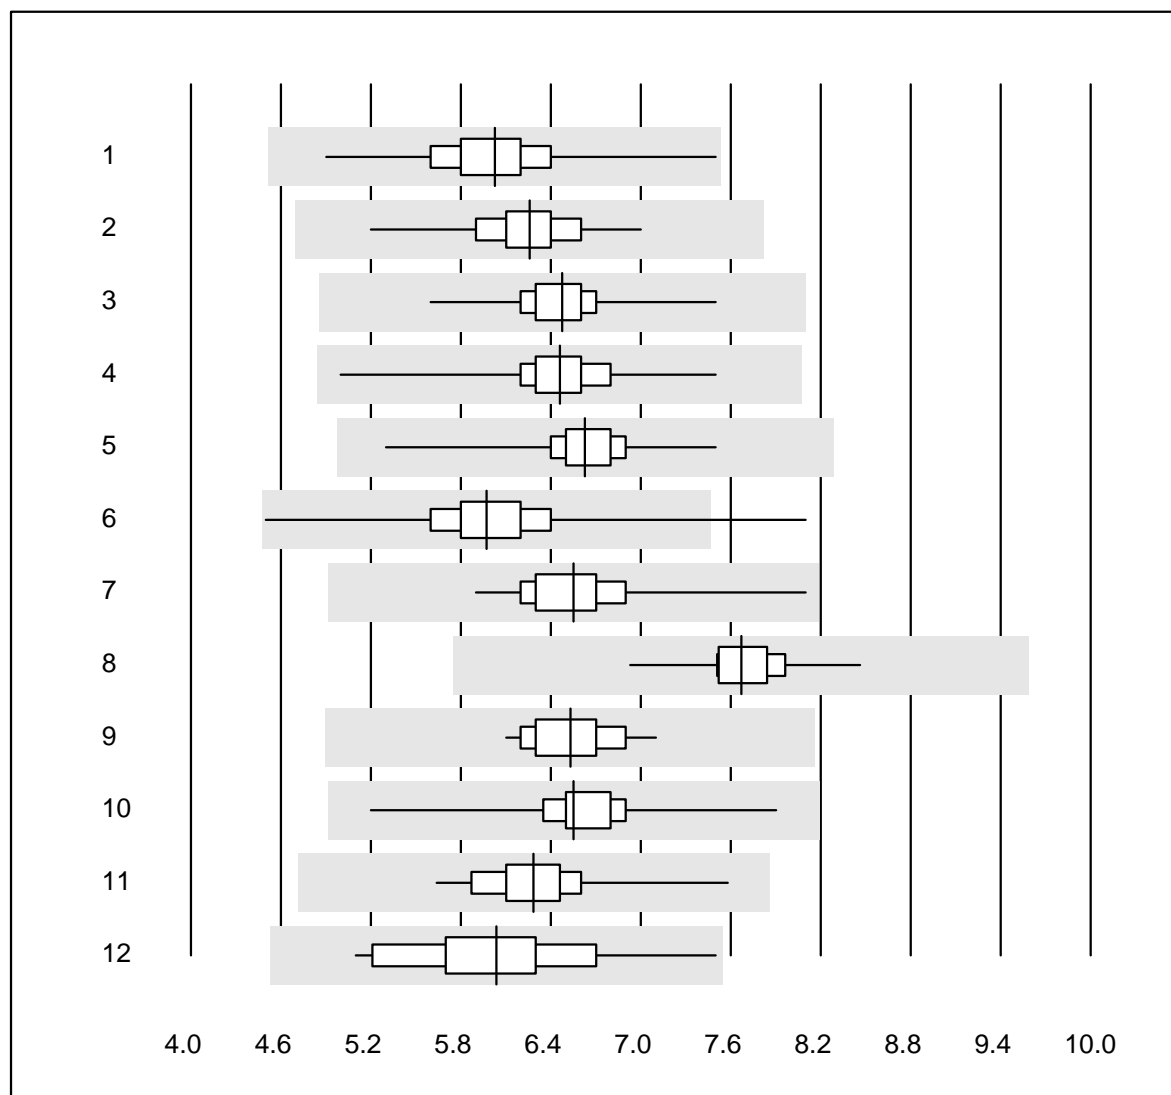


Tolérance QUALAB : 25 %

Leucocytes (G/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Abx Micros	607	98.4	0.0	1.6	6.03	5.5	e
2	Microsemi	492	99.2	0.0	0.8	6.26	3.9	e
3	Sysmex KX21	355	99.7	0.0	0.3	6.48	3.5	e
4	Sysmex PochH - 100i	206	100.0	0.0	0.0	6.46	4.6	e
5	Sysmex XP 300	348	99.7	0.0	0.3	6.63	3.5	e
6	Mythic	247	99.2	0.4	0.4	5.97	6.1	e
7	Swelab	67	100.0	0.0	0.0	6.55	5.3	e
8	Abacus Junior	11	100.0	0.0	0.0	7.67	4.8	e
9	Medonic	14	100.0	0.0	0.0	6.53	4.5	e
10	Nihon Kohden Celltac	46	100.0	0.0	0.0	6.55	6.1	e
11	Samsung HC10	45	100.0	0.0	0.0	6.28	5.3	e
12	Norma Icon 3	20	100.0	0.0	0.0	6.04	9.5	e

Thrombocytes

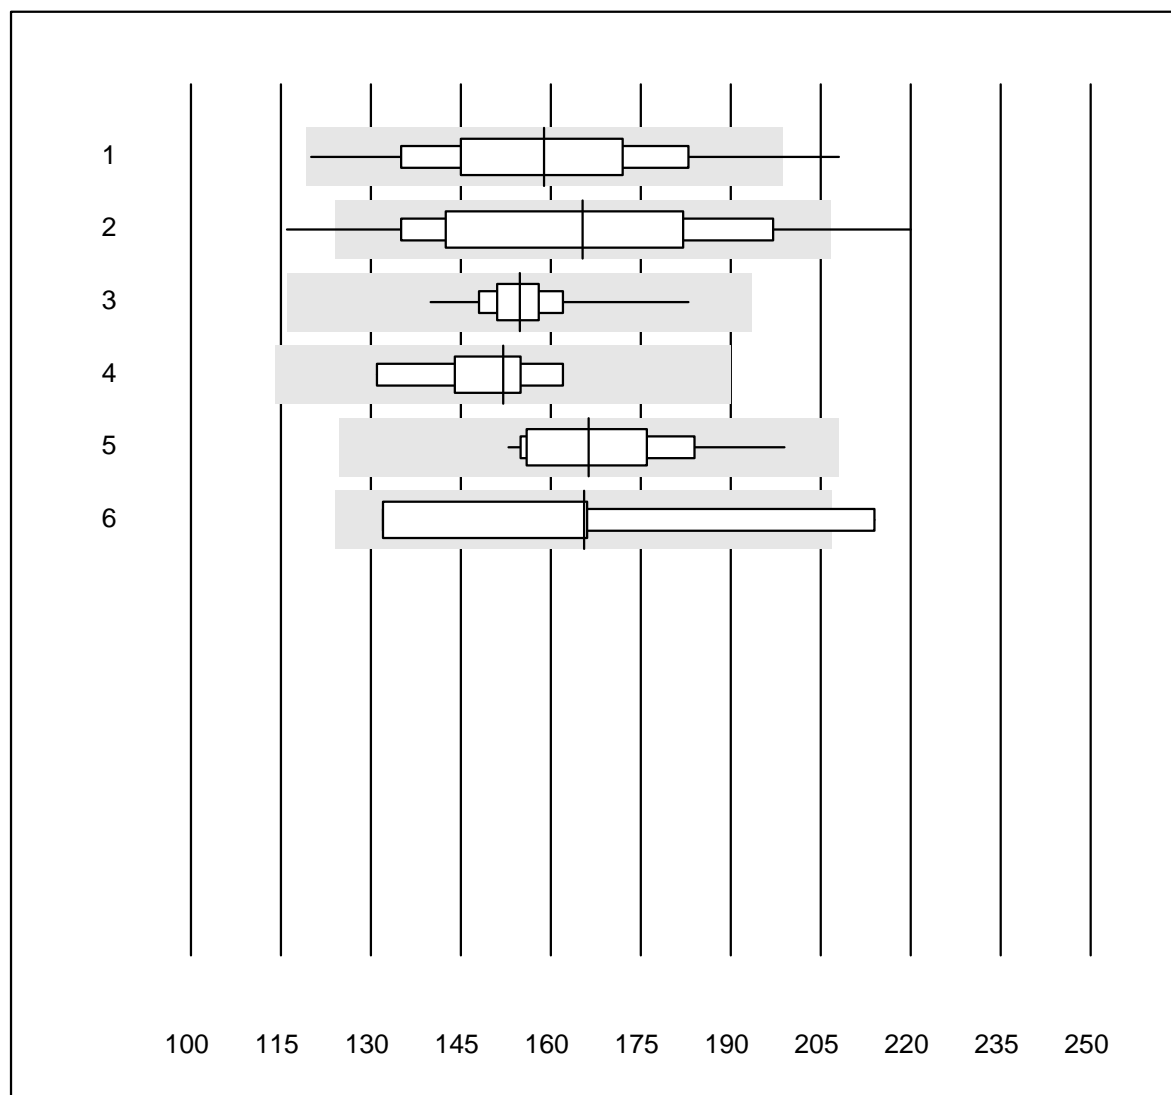


Tolérance QUALAB : 25 %

Thrombocytes (G/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Automate	21	95.2	4.8	0.0	158.8	13.1	e
2	Microscopie	24	83.4	8.3	8.3	165.3	15.7	e*
3	Sysmex X	41	100.0	0.0	0.0	154.9	4.7	e
4	Advia 120	9	100.0	0.0	0.0	152.0	6.2	e
5	ABX Pentra	11	100.0	0.0	0.0	166.3	9.0	e
6	MS4	4	75.0	25.0	0.0	165.5	19.9	e*

Thrombocytes

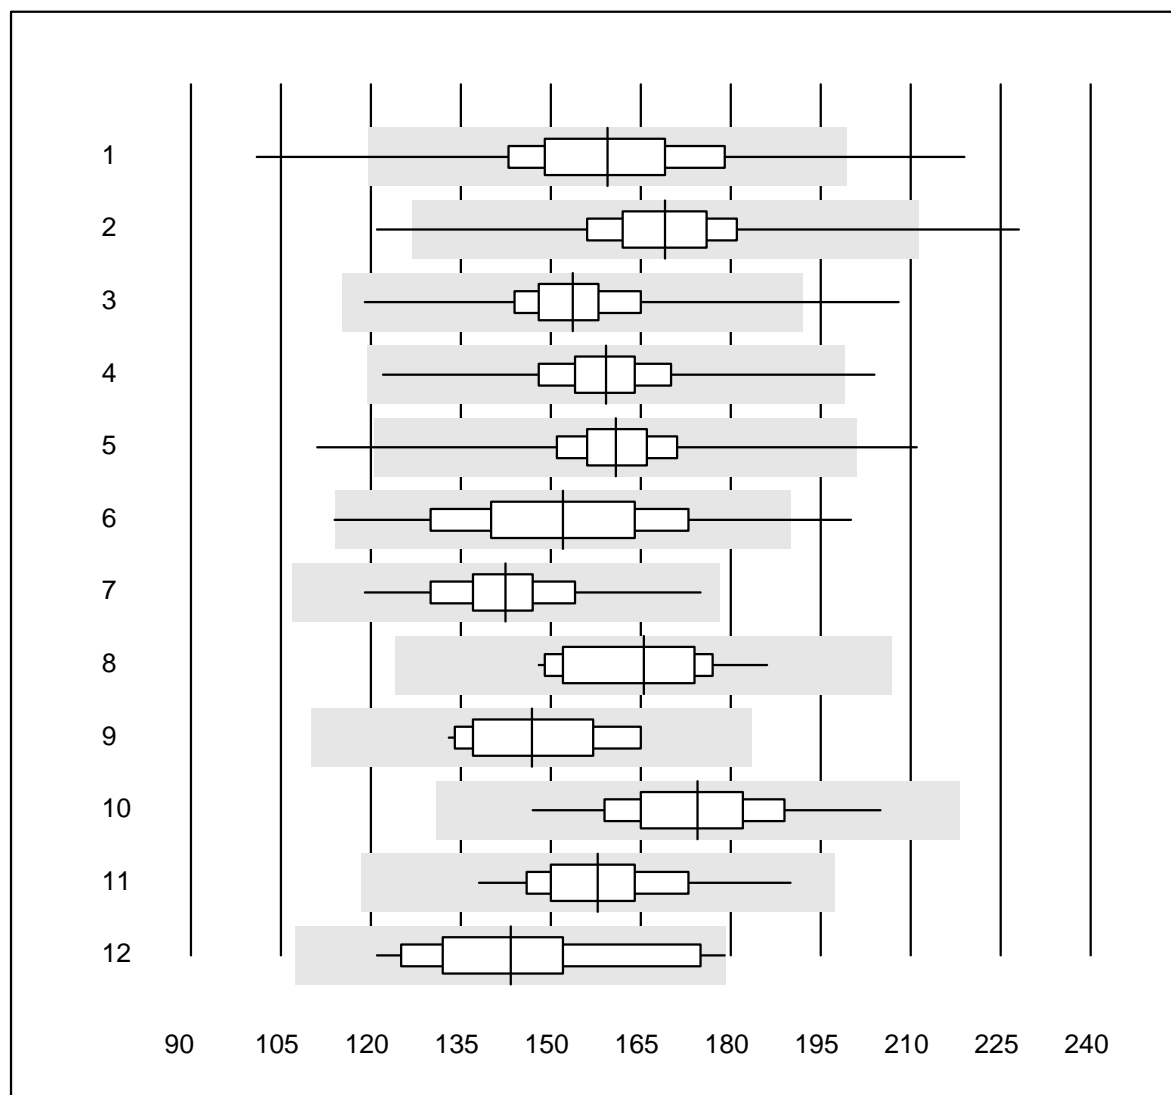


Tolérance QUALAB : 25 %

Thrombocytes (G/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Abx Micros	606	95.1	2.1	2.8	159.4	9.8	e
2	Microsemi	492	98.8	0.8	0.4	169.0	6.6	e
3	Sysmex KX21	355	99.7	0.3	0.0	153.6	5.7	e
4	Sysmex PochH - 100i	206	99.0	0.5	0.5	159.2	5.8	e
5	Sysmex XP 300	347	98.8	0.6	0.6	160.8	5.8	e
6	Mythic	249	94.8	2.4	2.8	152.0	11.1	e
7	Swelab	67	98.5	0.0	1.5	142.5	7.5	e
8	Abacus Junior	11	100.0	0.0	0.0	165.5	7.4	e
9	Medonic	14	100.0	0.0	0.0	146.9	7.4	e
10	Nihon Kohden Celltac	46	91.3	0.0	8.7	174.5	6.9	e
11	Samsung HC10	45	100.0	0.0	0.0	157.8	7.3	e
12	Norma Icon 3	20	95.0	0.0	5.0	143.3	10.8	e

Hémoglobine BG

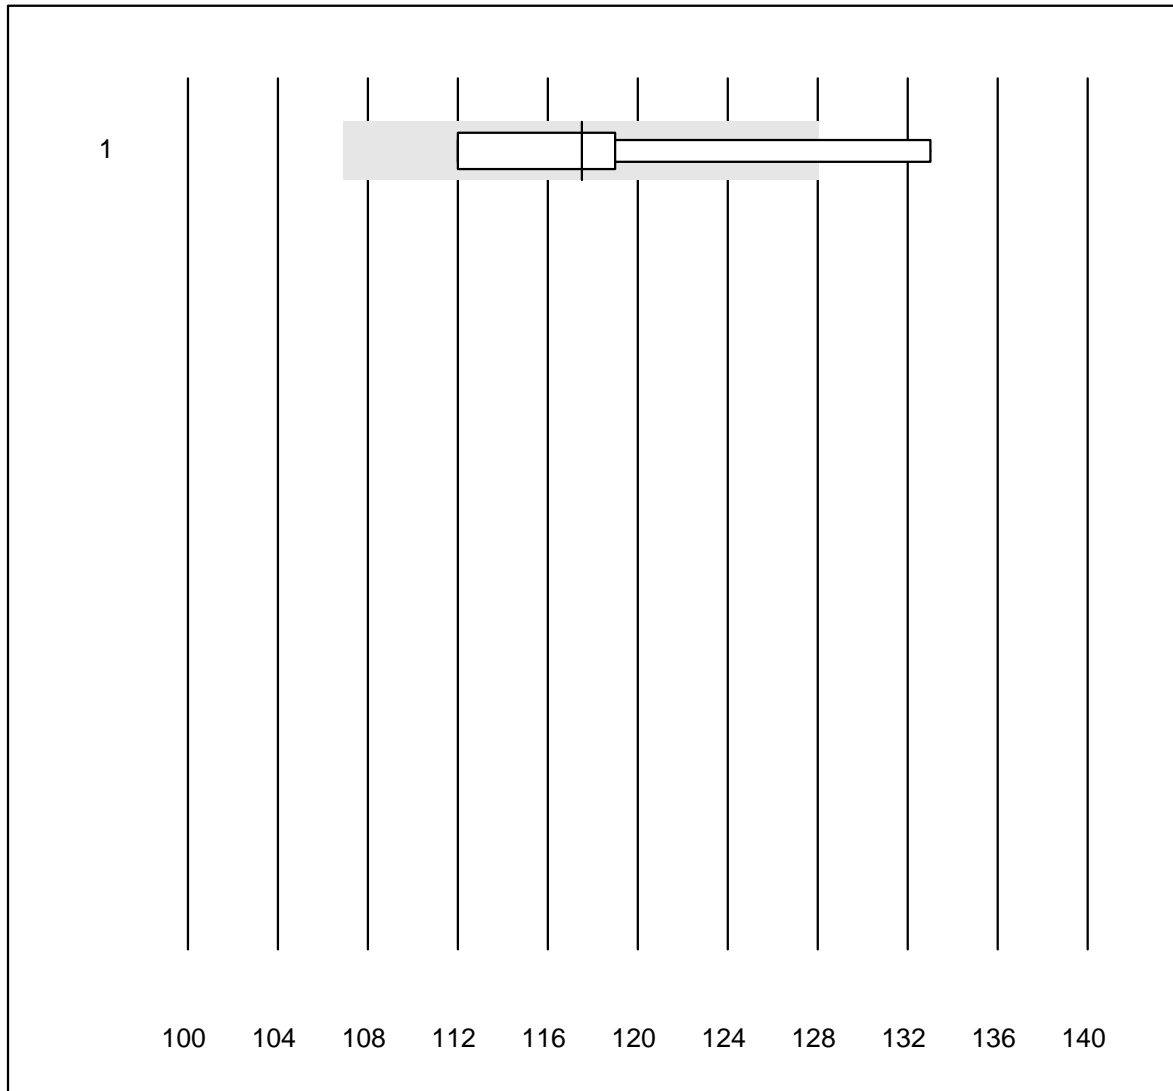


Tolérance QUALAB : 9 %

Hémoglobine BG (g/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 iStat	6	83.3	16.7	0.0	117.5	6.6	e*

Hématocrite

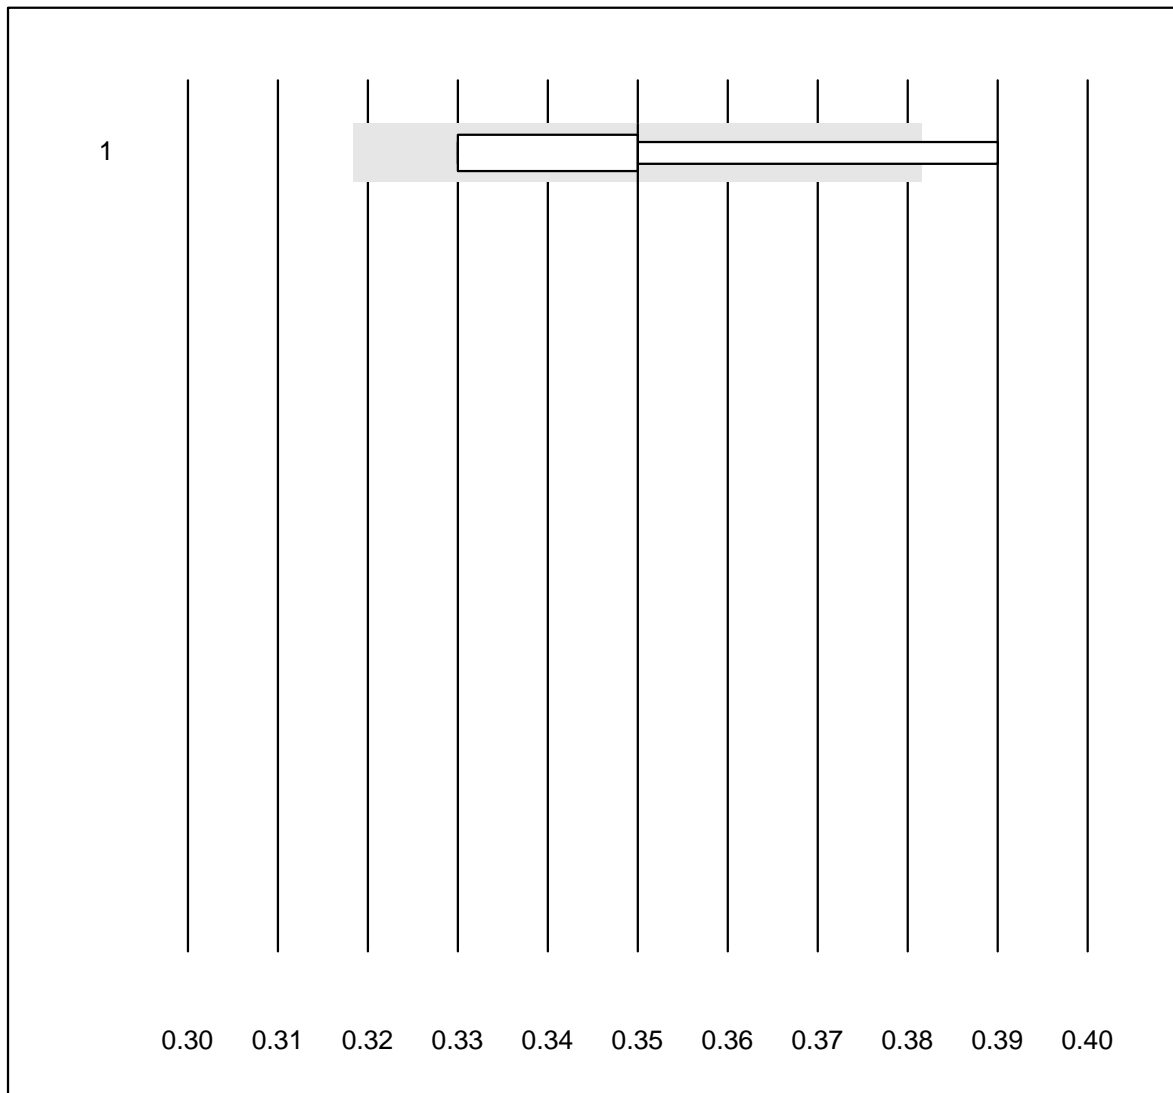


Tolérance QUALAB : 9 %

Hématocrite (l/l)


No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 iStat	7	85.7	14.3	0.0	0.35	5.8	e*

Hémoglobine

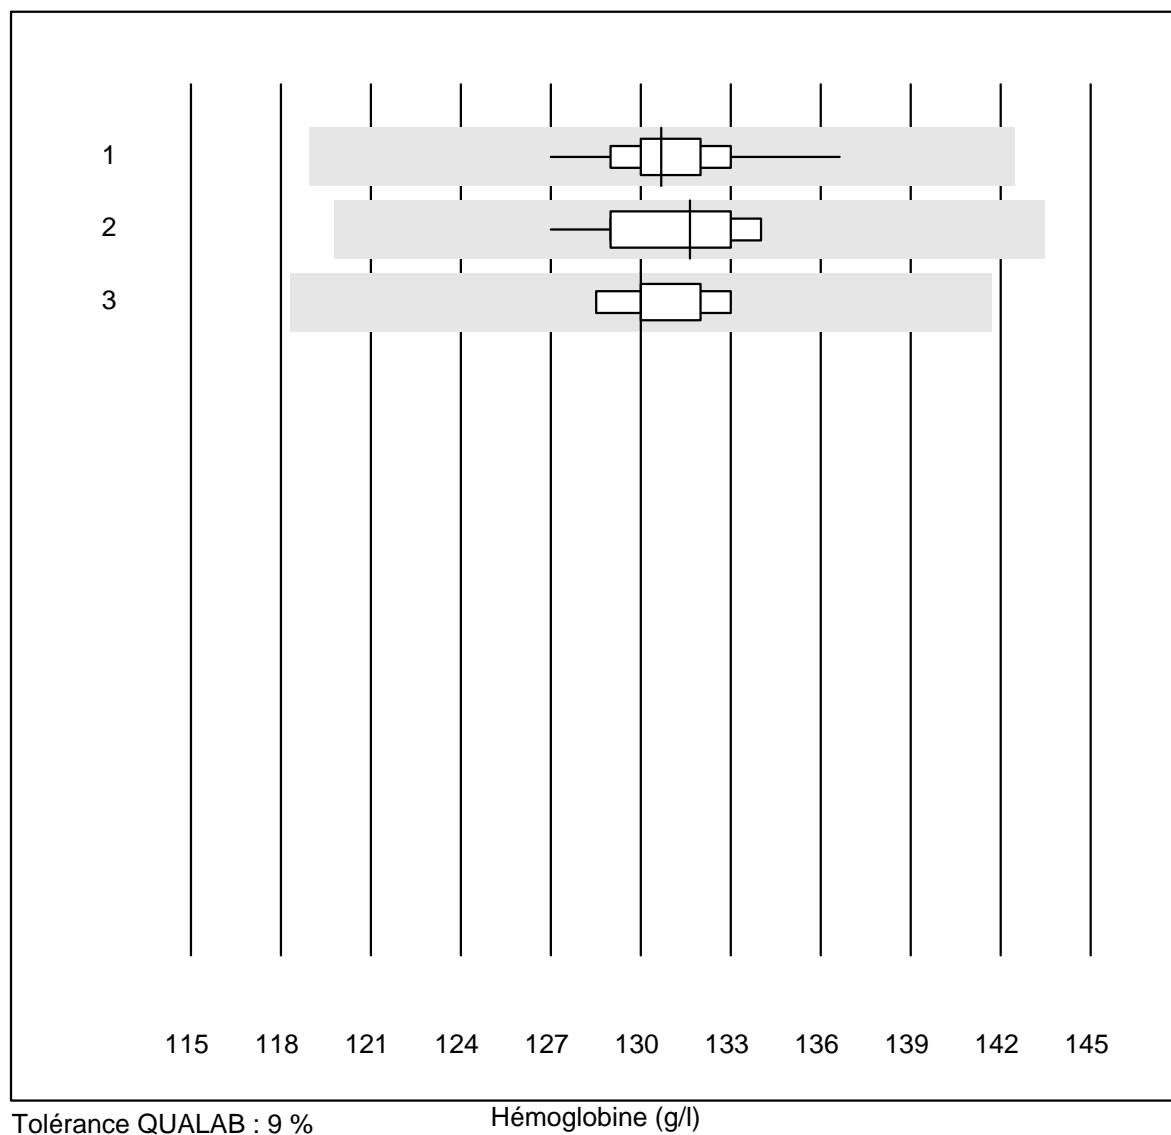

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Sysmex	43	100.0	0.0	0.0	130.7	1.4	e
2	Advia	11	100.0	0.0	0.0	131.6	1.7	e
3	ABX Pentra	7	100.0	0.0	0.0	130.0	1.1	e

Hématocrite

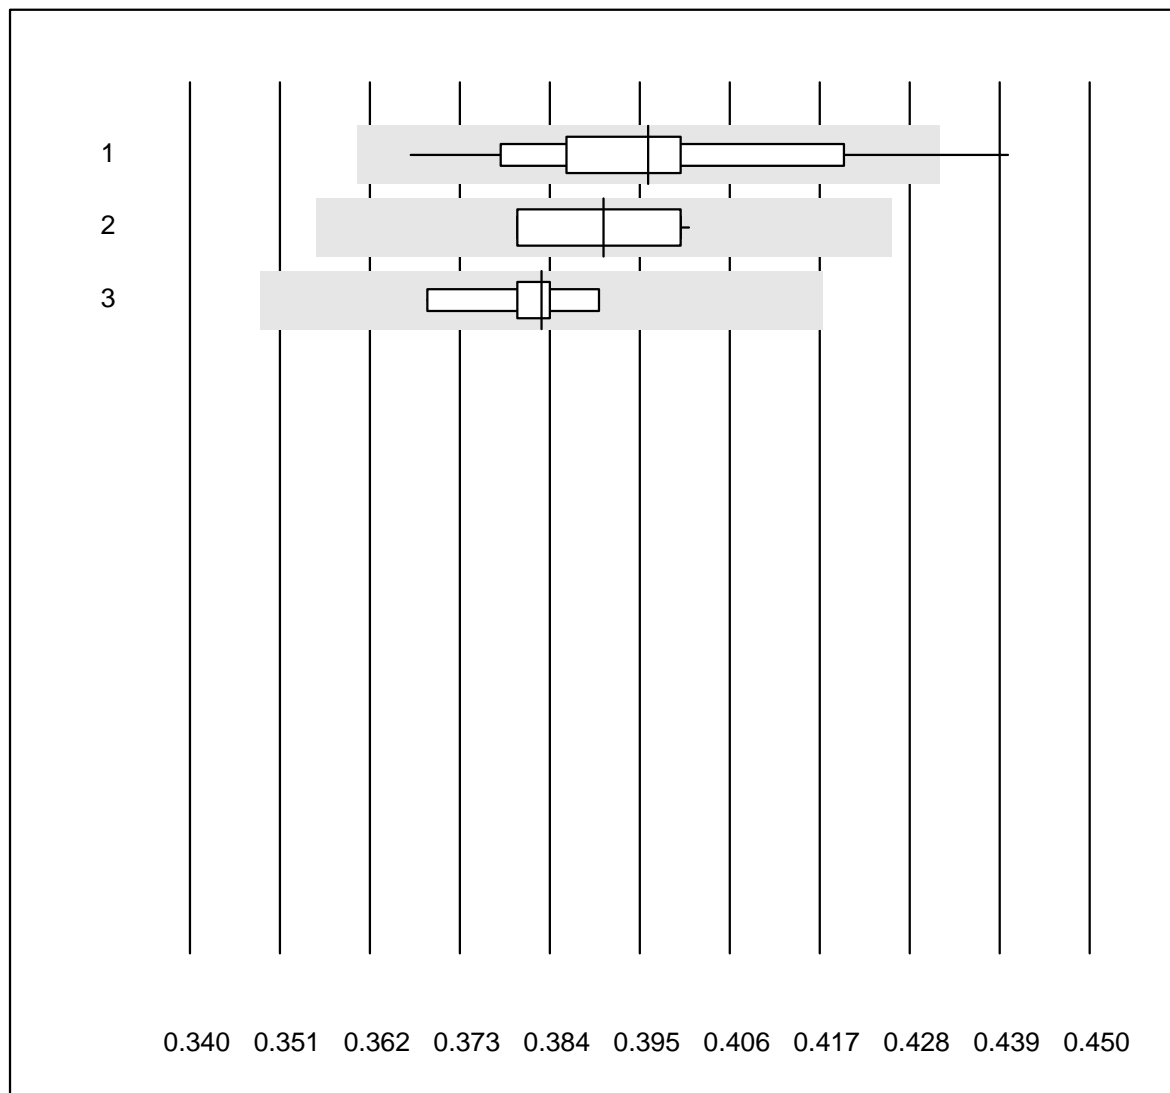


Tolérance QUALAB : 9 %

Hématocrite (l/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Sysmex	43	95.4	2.3	2.3	0.40	3.9	e
2	Advia	11	100.0	0.0	0.0	0.39	2.2	e
3	ABX Pentra	7	100.0	0.0	0.0	0.38	1.7	e

Erythrocytes

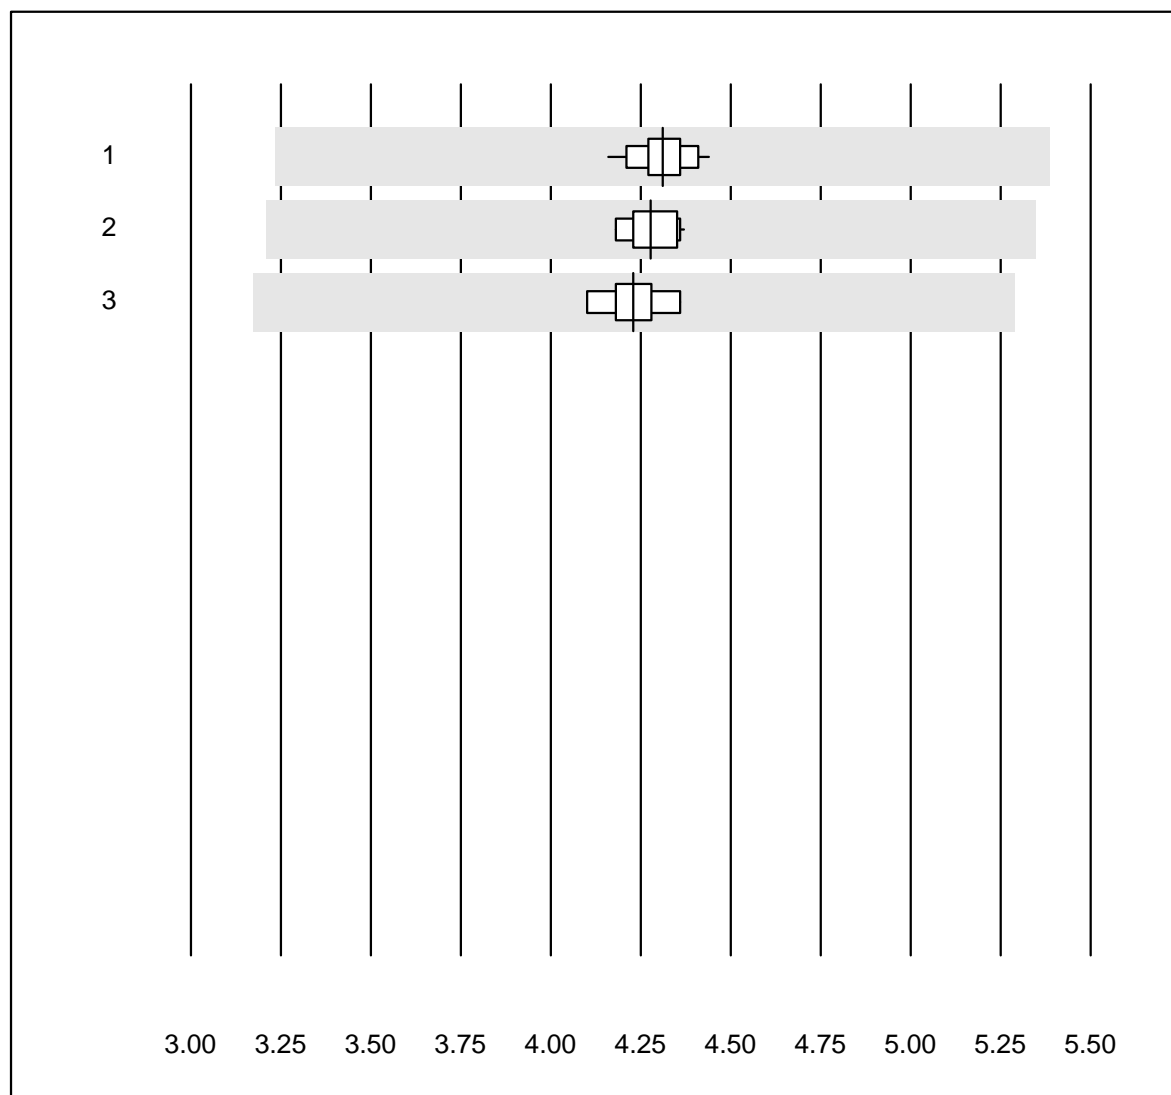


Tolérance QUALAB : 25 %

Erythrocytes (T/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Sysmex	43	100.0	0.0	0.0	4.31	1.6	e
2	Advia	11	100.0	0.0	0.0	4.28	1.6	e
3	ABX Pentra	7	100.0	0.0	0.0	4.23	1.9	e

Leucocytes

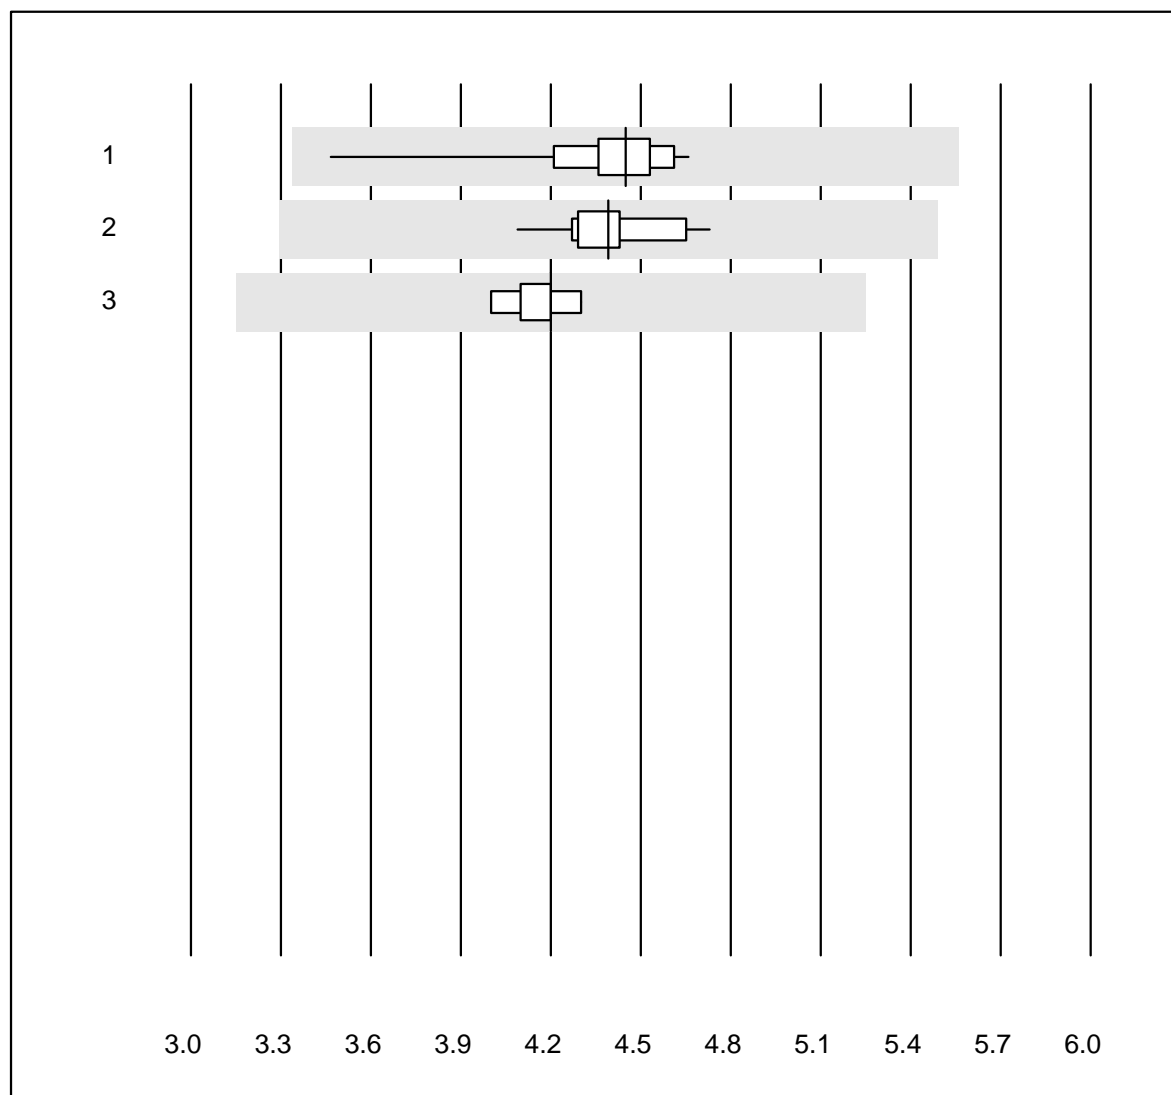


Tolérance QUALAB : 25 %

Leucocytes (G/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Sysmex	43	100.0	0.0	0.0	4.45	4.6	e
2 Advia	11	100.0	0.0	0.0	4.39	4.0	e
3 ABX Pentra	7	100.0	0.0	0.0	4.20	2.3	e

Thrombocytes

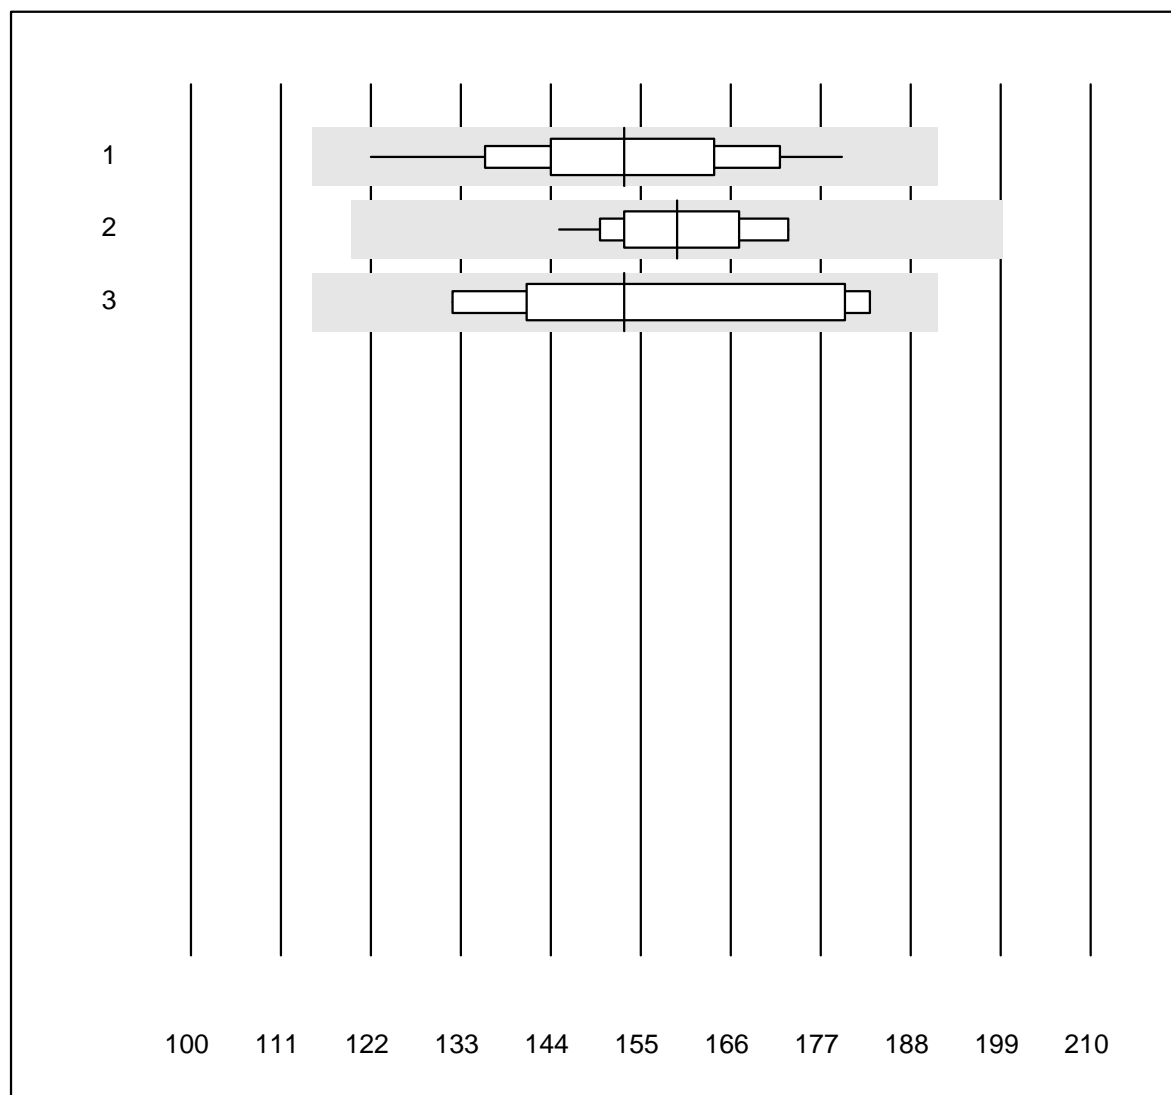


Tolérance QUALAB : 25 %

Thrombocytes (G/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Sysmex	43	97.7	0.0	2.3	153.0	9.2	e
2 Advia	11	100.0	0.0	0.0	159.5	5.6	e
3 ABX Pentra	7	100.0	0.0	0.0	153.0	12.0	e*

Neutrophiles

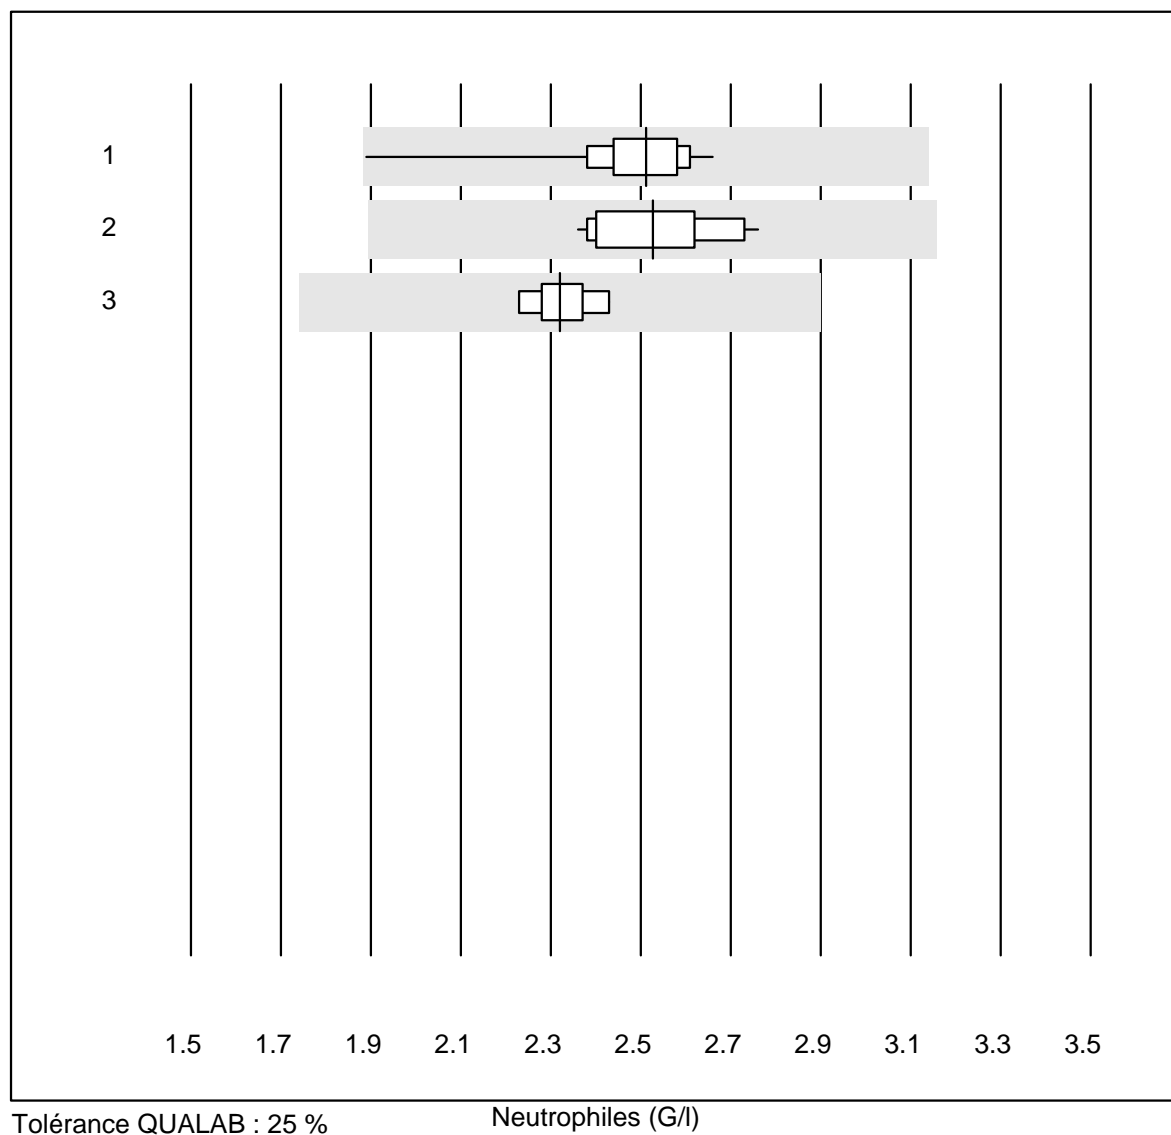

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Sysmex	43	100.0	0.0	0.0	2.51	5.1	e
2 Advia	11	100.0	0.0	0.0	2.53	5.4	e
3 ABX Pentra	7	100.0	0.0	0.0	2.32	2.8	e

Lymphocytes

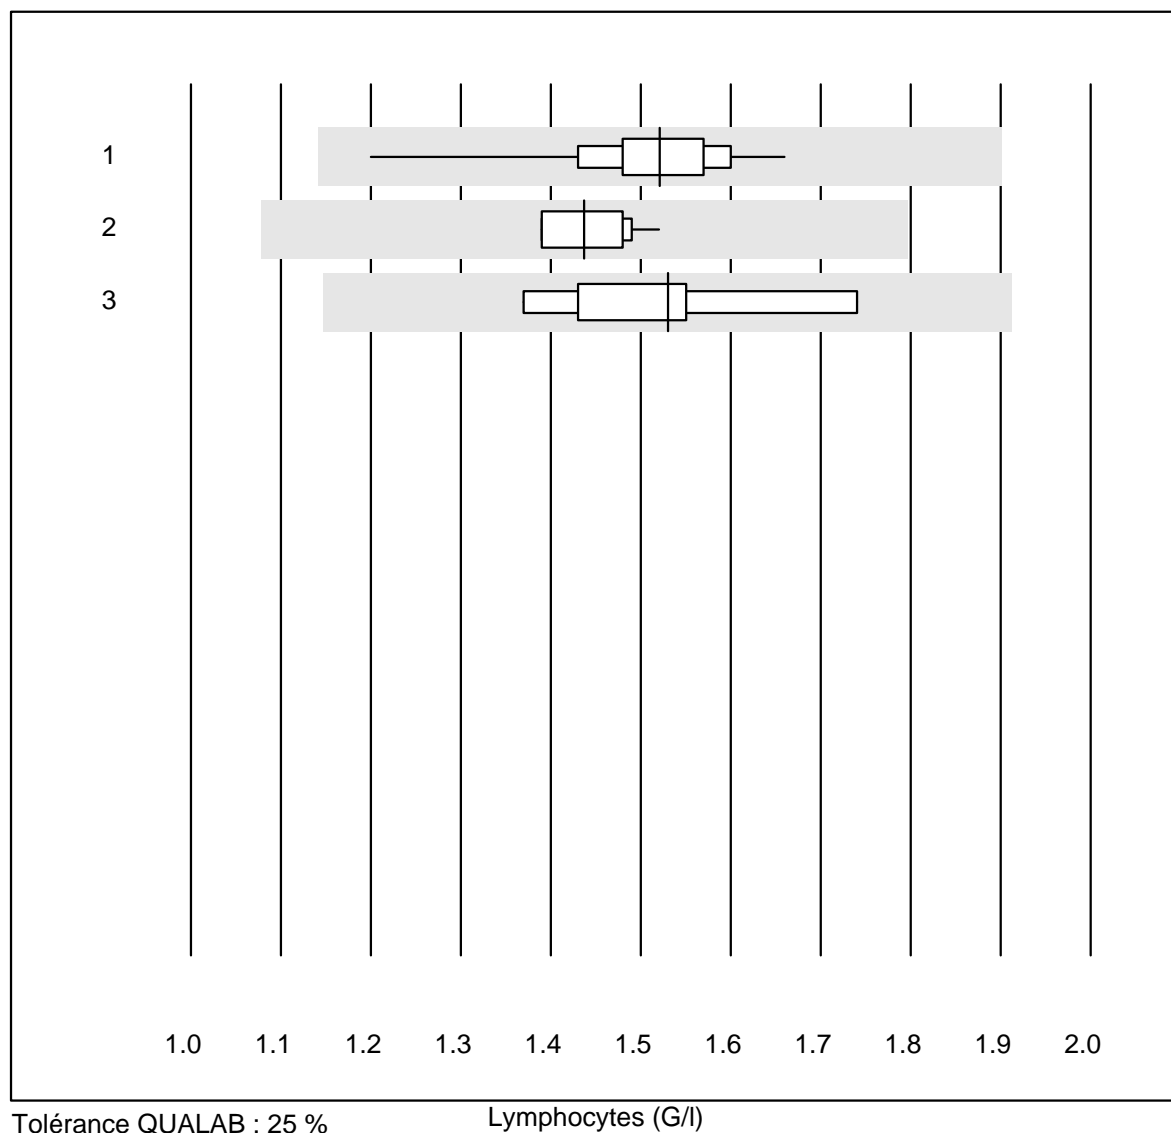


Tolérance QUALAB : 25 %

Lymphocytes (G/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Sysmex	43	100.0	0.0	0.0	1.52	5.7	e
2	Advia	11	100.0	0.0	0.0	1.44	3.3	e
3	ABX Pentra	7	100.0	0.0	0.0	1.53	7.7	e

Monocytes

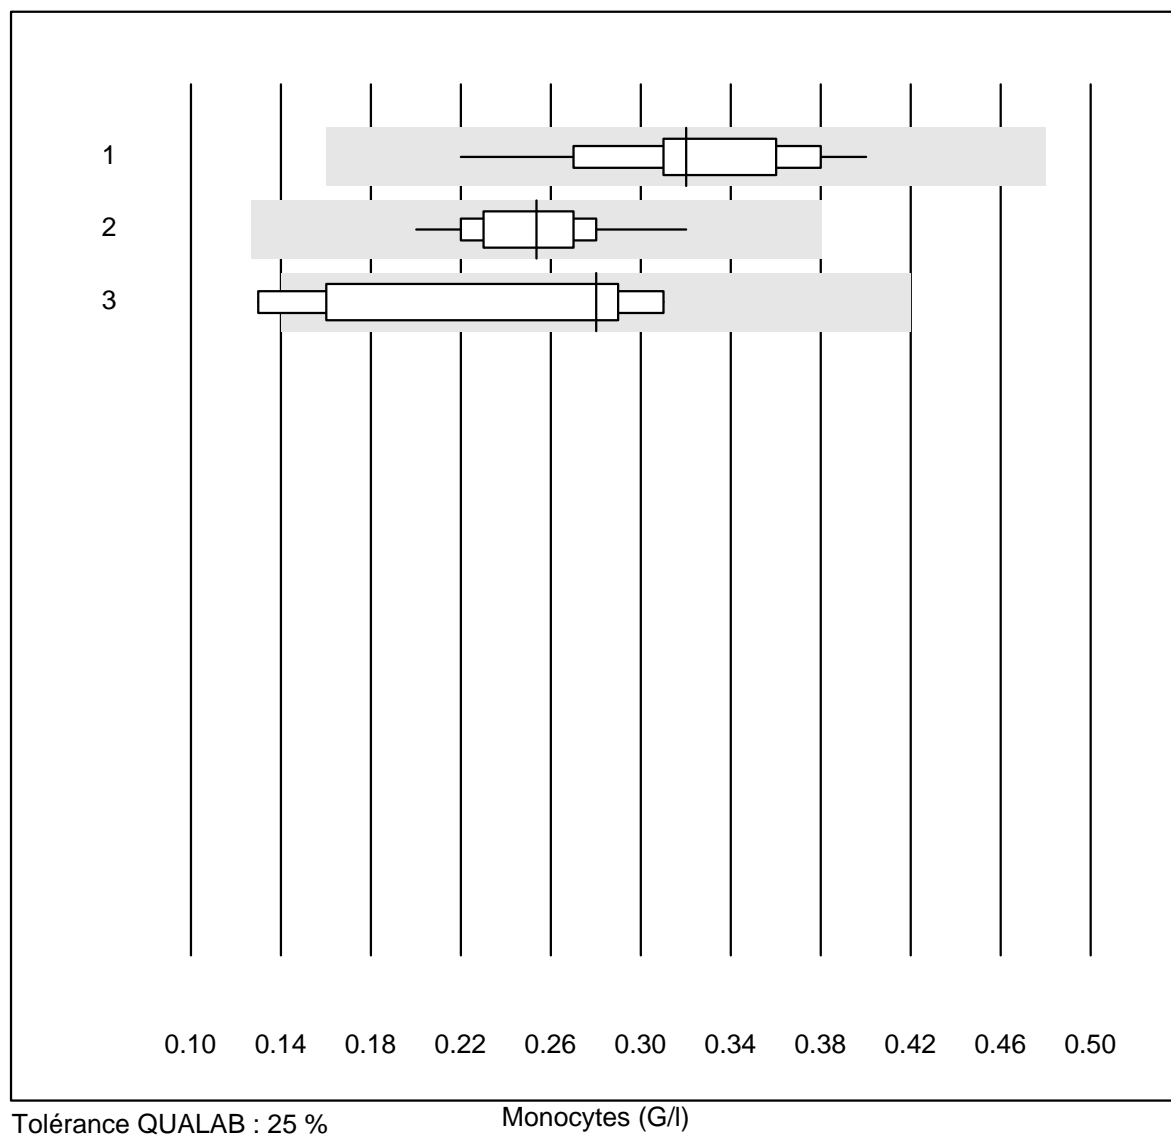

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Sysmex	43	100.0	0.0	0.0	0.32	13.5	a
2 Advia	11	100.0	0.0	0.0	0.25	13.0	a
3 ABX Pentra	7	85.7	14.3	0.0	0.28	28.7	a

Eosinophiles

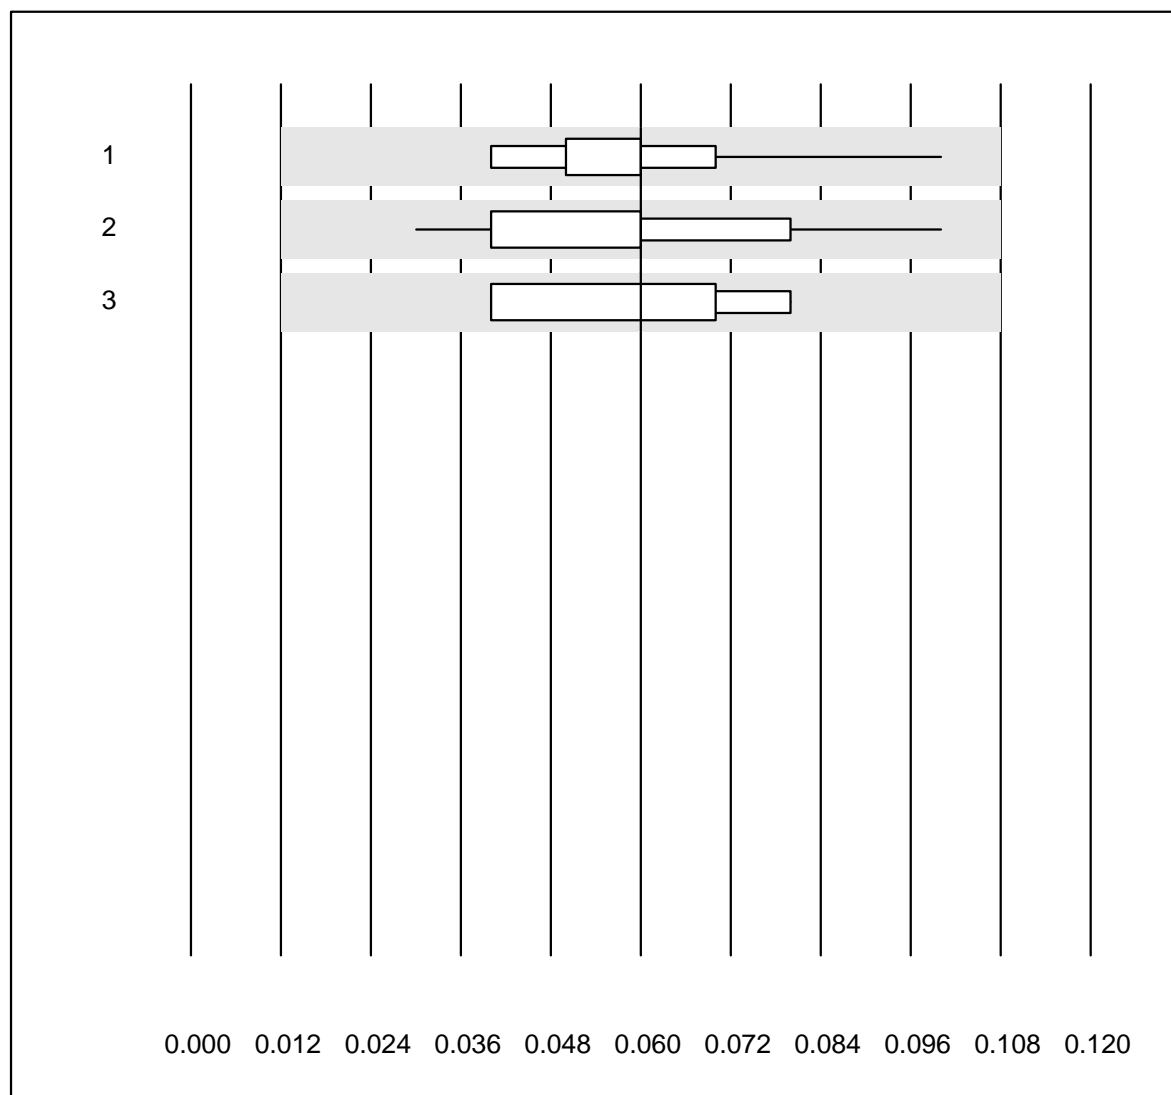


Tolérance QUALAB : 50 %

Eosinophiles (G/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Sysmex	43	100.0	0.0	0.0	0.06	28.9	a
2 Advia	11	100.0	0.0	0.0	0.06	36.7	a
3 ABX Pentra	7	100.0	0.0	0.0	0.06	26.2	a

Basophiles

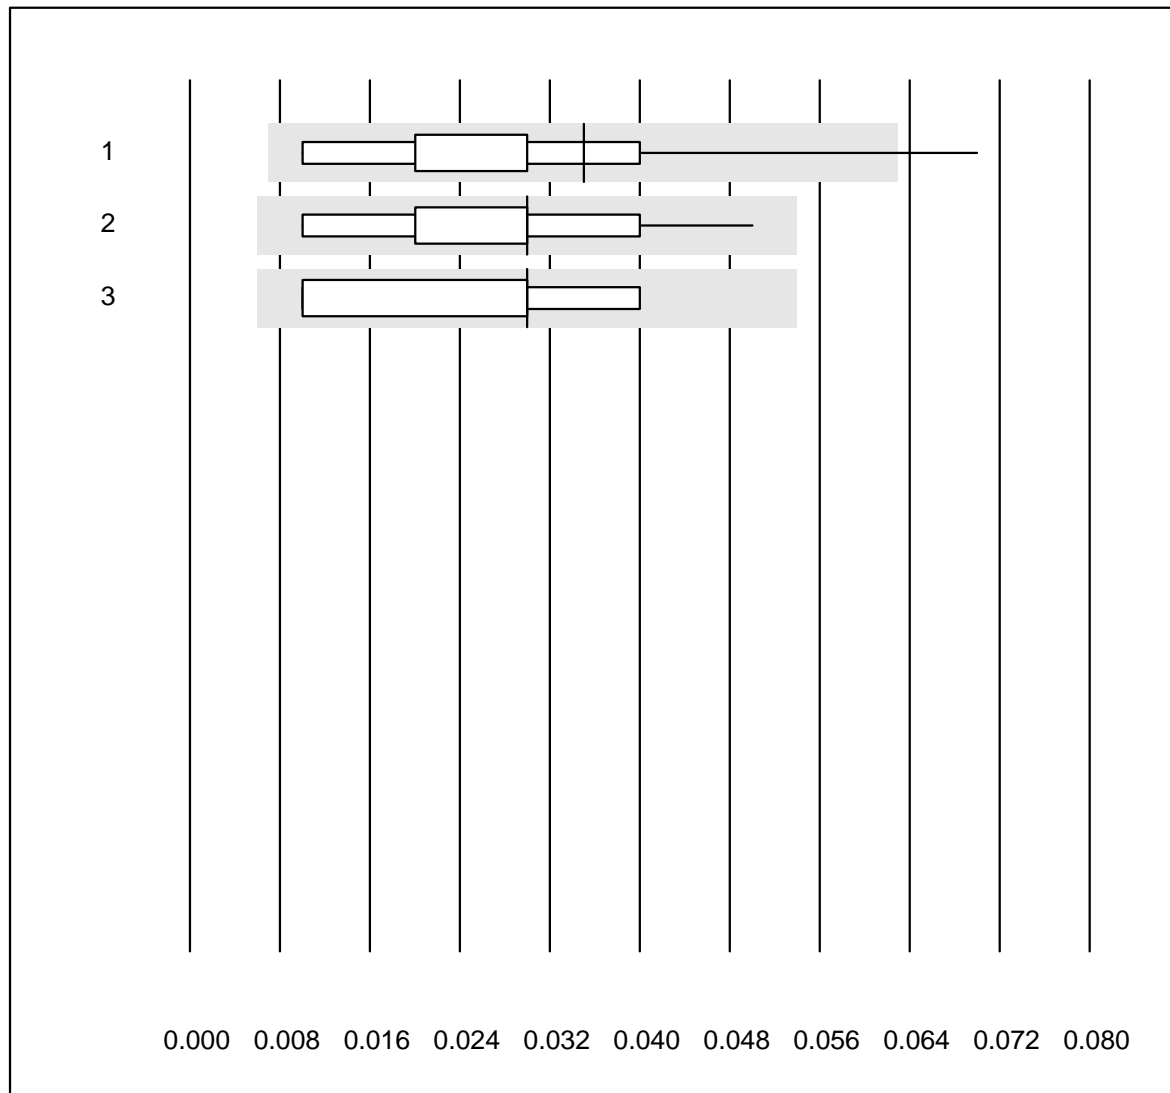


Tolérance QUALAB : 80 %

Basophiles (G/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Sysmex	42	97.6	2.4	0.0	0.04	53.6	a
2	Advia	11	100.0	0.0	0.0	0.03	45.7	a
3	ABX Pentra	7	100.0	0.0	0.0	0.03	64.5	a

Réticulocytes

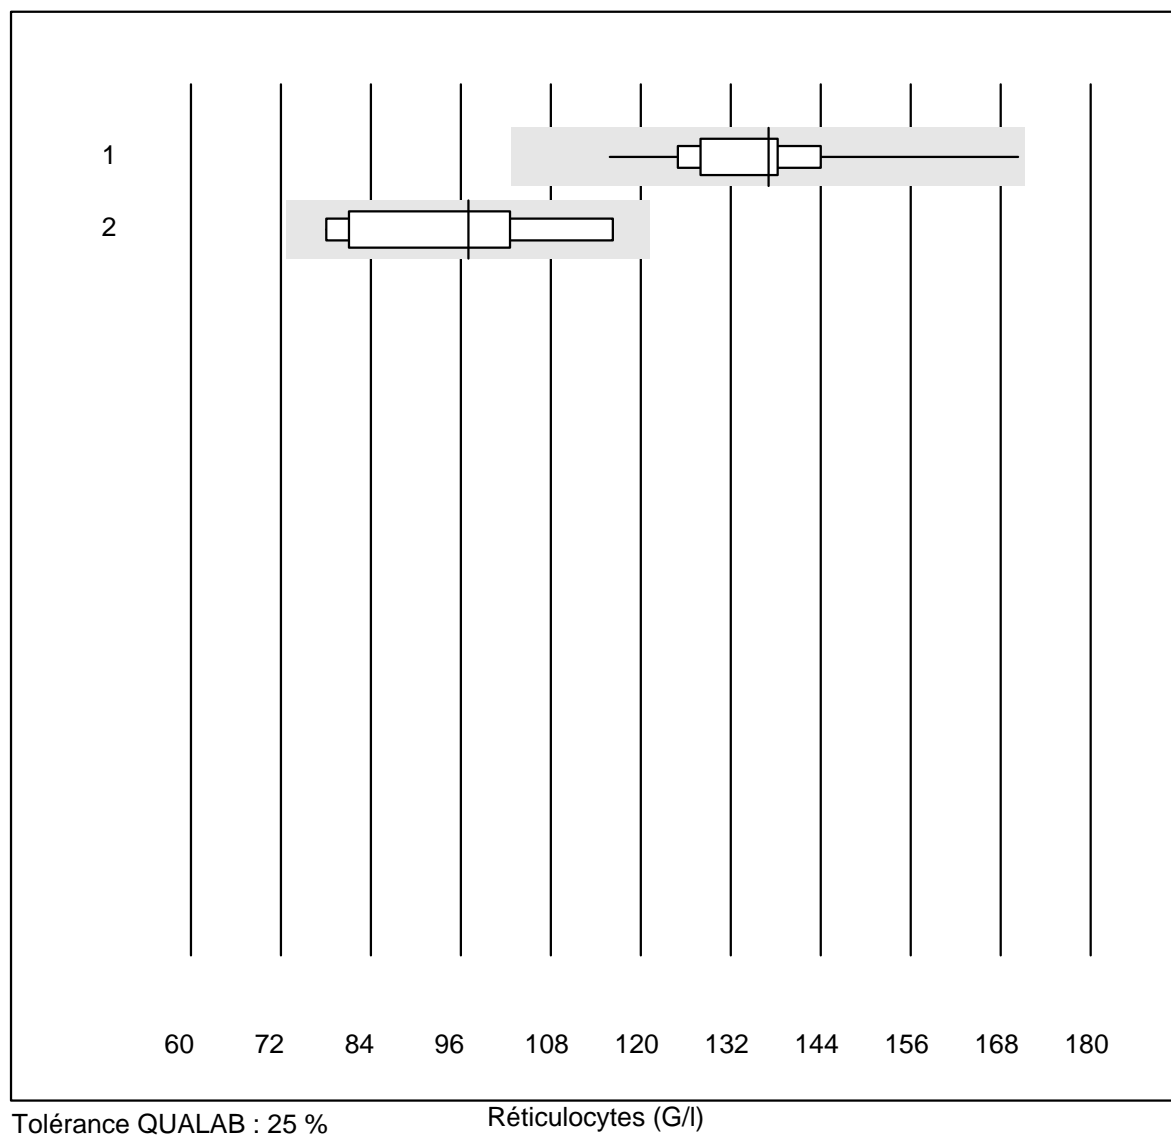

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Sysmex	21	100.0	0.0	0.0	137.0	8.4	a
2 Advia	8	100.0	0.0	0.0	97.0	14.8	a

Hämolyseindex Probe A

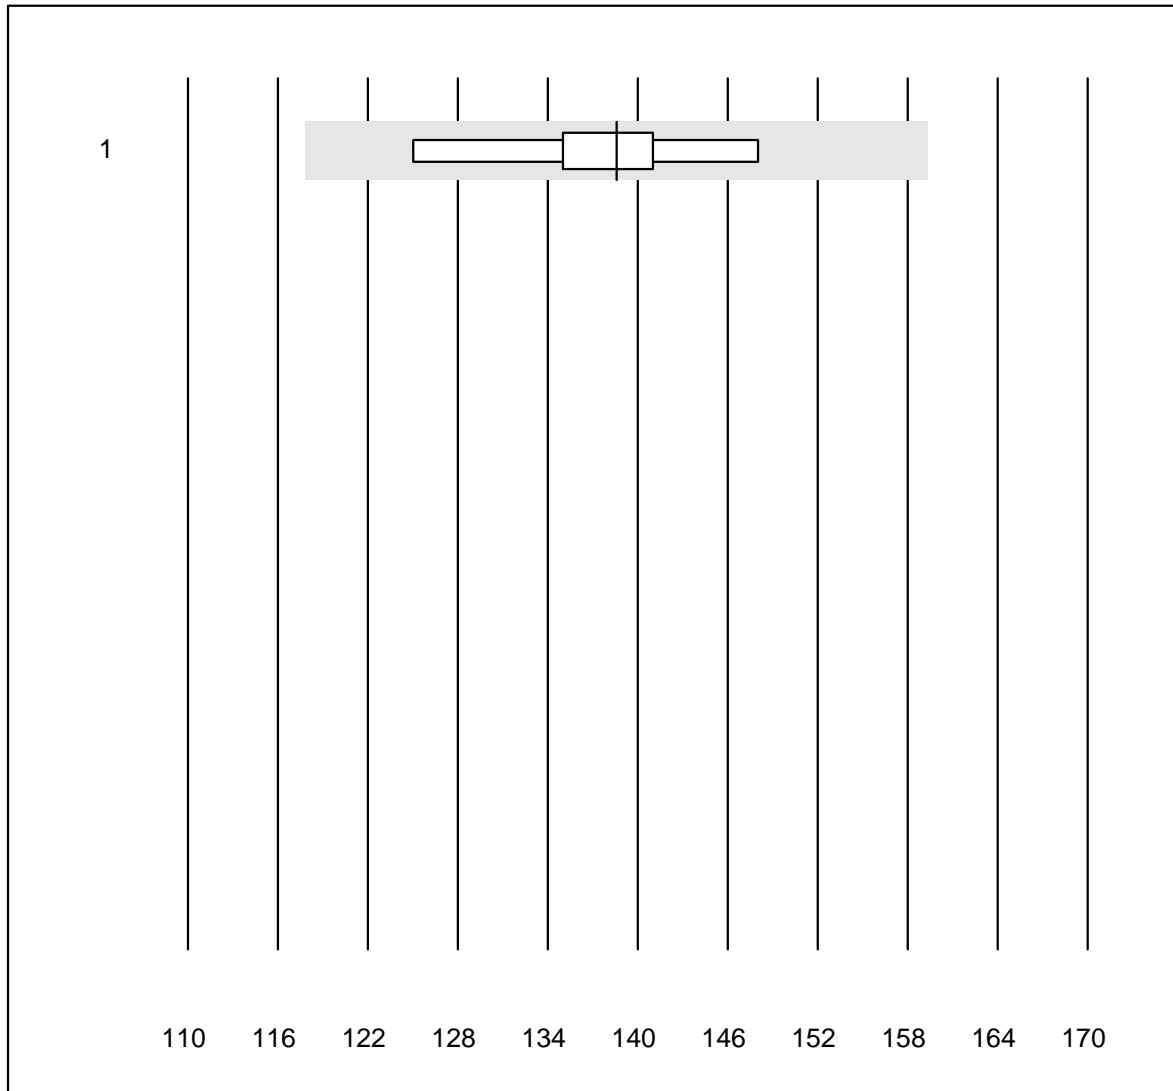


Tolérance QUALAB : 15 %

Hämolyseindex Probe A ()

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas	17	94.1	0.0	5.9	138.6	5.1	e

Hämolyseindex Probe B

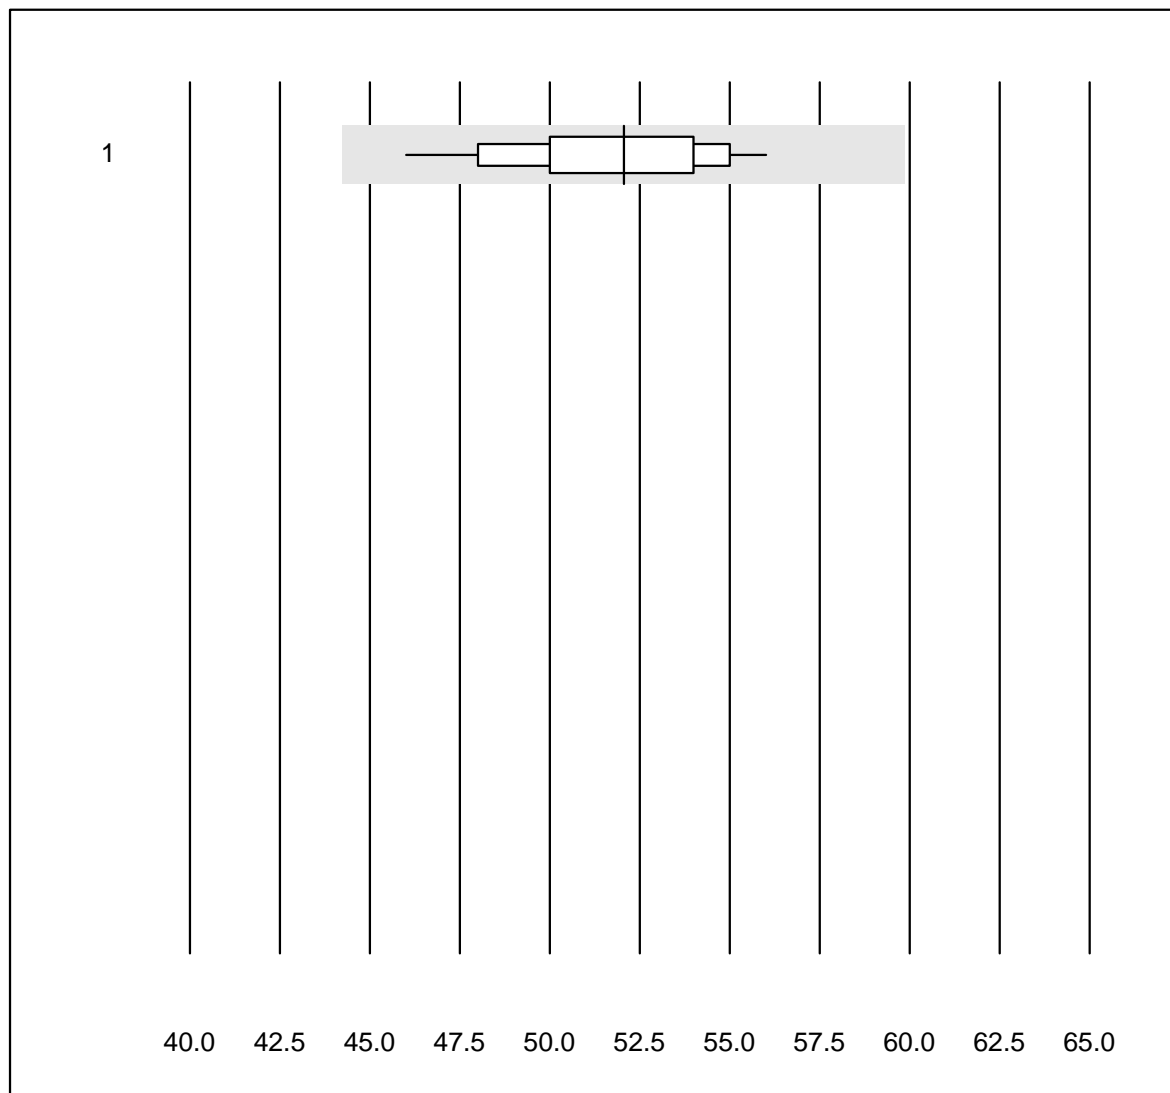


Tolérance QUALAB : 15 %

Hämolyseindex Probe B ()

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas	17	94.1	0.0	5.9	52.1	5.2	e


Vitesse de sédimentation 1h

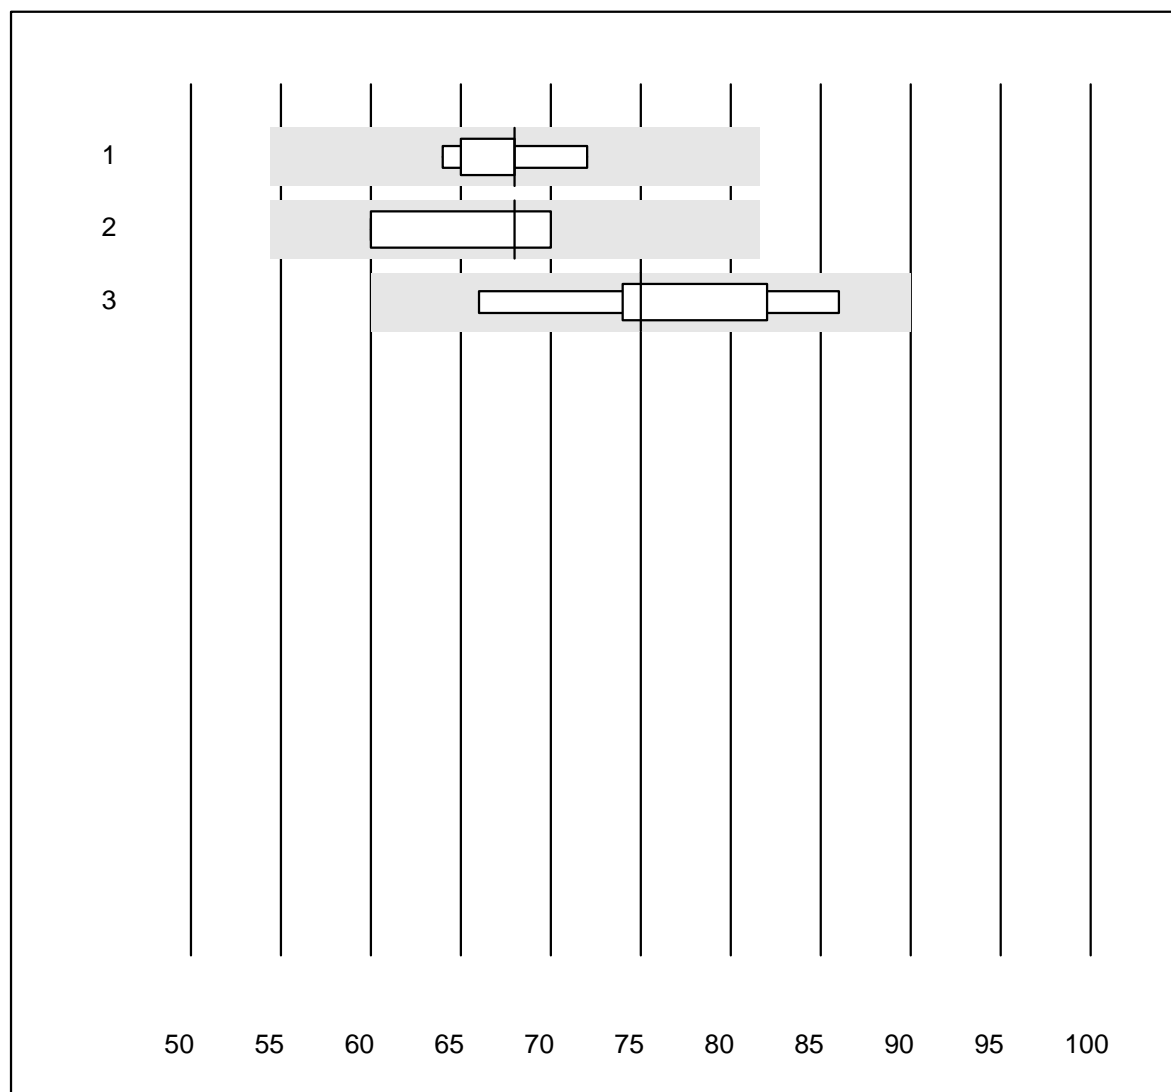

Tolérance QUALAB : 20 % Vitesse de sédimentation 1h (mm/h)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Sarstedt Sedivette	8	75.0	0.0	25.0	68	4.3	a
2 BD Seditainer	7	100.0	0.0	0.0	68	7.6	e*
3 Autres méthodes	5	100.0	0.0	0.0	75	10.1	e*

CRP

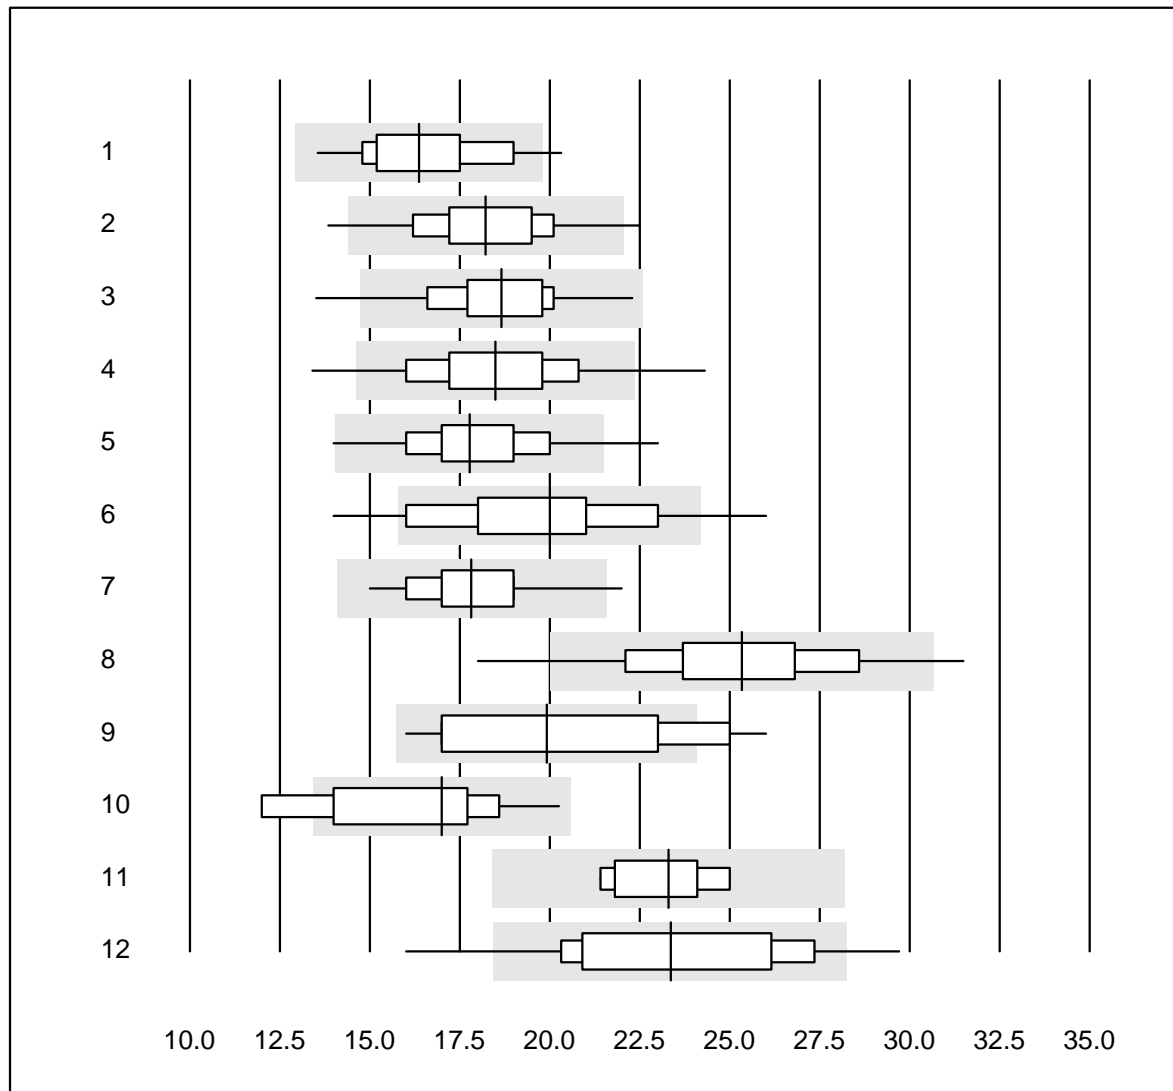


Tolérance QUALAB : 21 %

CRP (mg/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas	15	93.3	6.7	0.0	16.4	10.7	e*
2	Turbidimetrie	39	92.3	5.1	2.6	18.2	9.5	e
3	Abx Micros	49	98.0	2.0	0.0	18.7	9.2	e
4	ABX Micros CRP200	247	92.8	4.0	3.2	18.5	10.1	e
5	Afinion	1295	97.8	1.8	0.4	17.8	8.2	e
6	NycoCard SingleTest-	285	78.6	10.5	10.9	20.0	13.6	e
7	Quick Read go	172	97.1	1.2	1.7	17.8	6.9	e
8	Eurolyser	129	72.9	3.1	24.0	25.3	10.0	e
9	Fuji Dri-Chem	26	77.0	11.5	11.5	19.9	16.2	e*
10	Autolyser/DiaSys	10	80.0	20.0	0.0	17.0	16.4	e*
11	Piccolo	7	100.0	0.0	0.0	23.3	5.4	e
12	AFIAS	16	68.7	12.5	18.8	23.4	15.6	e*

CRP

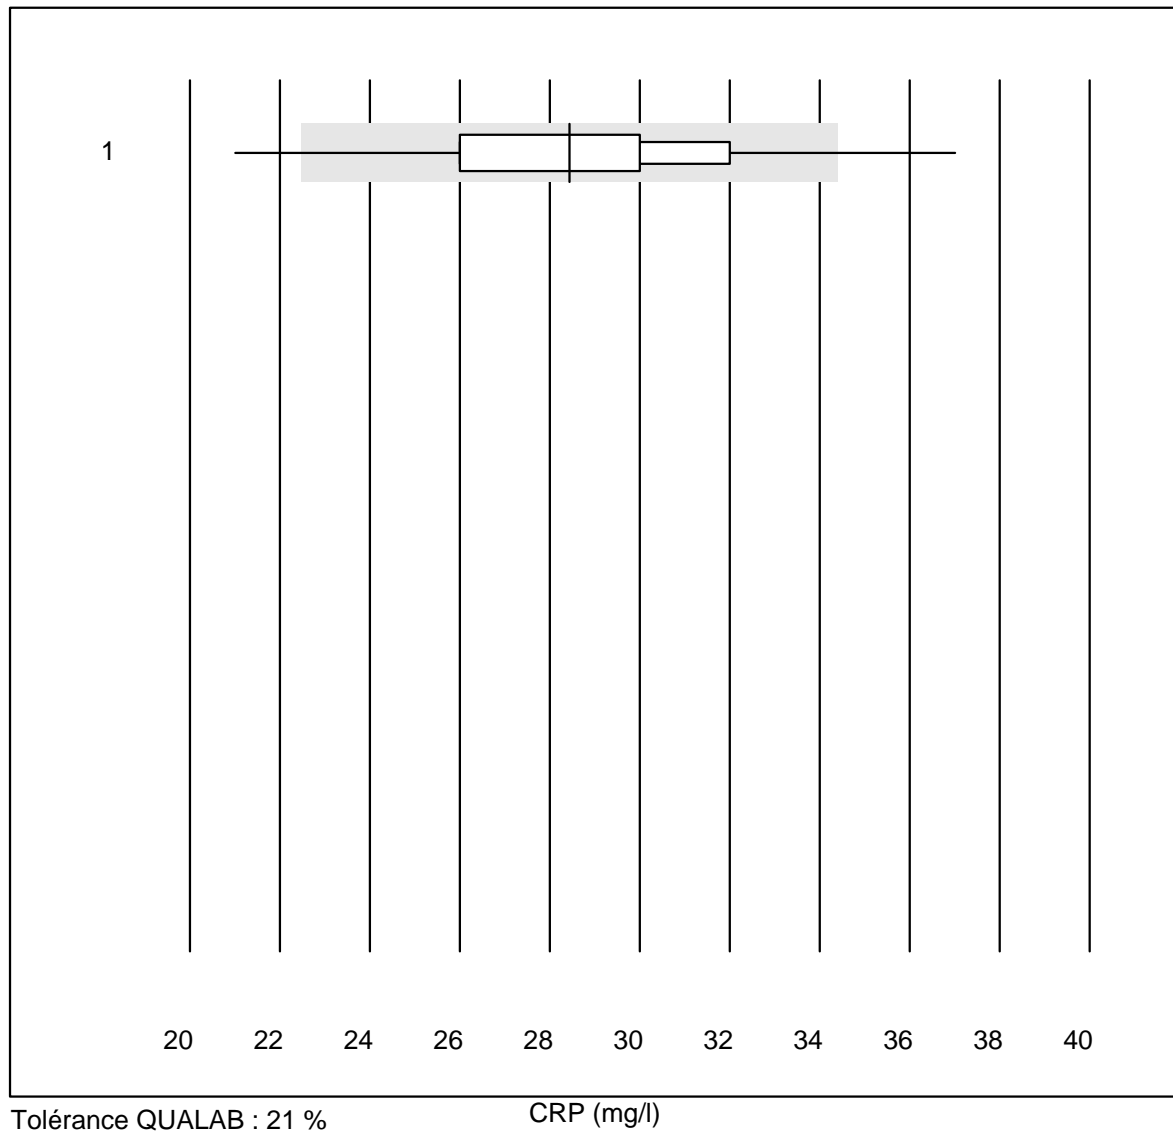


No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 QuickRead (sang comp	121	91.7	5.0	3.3	28.4	9.1	e

CRP

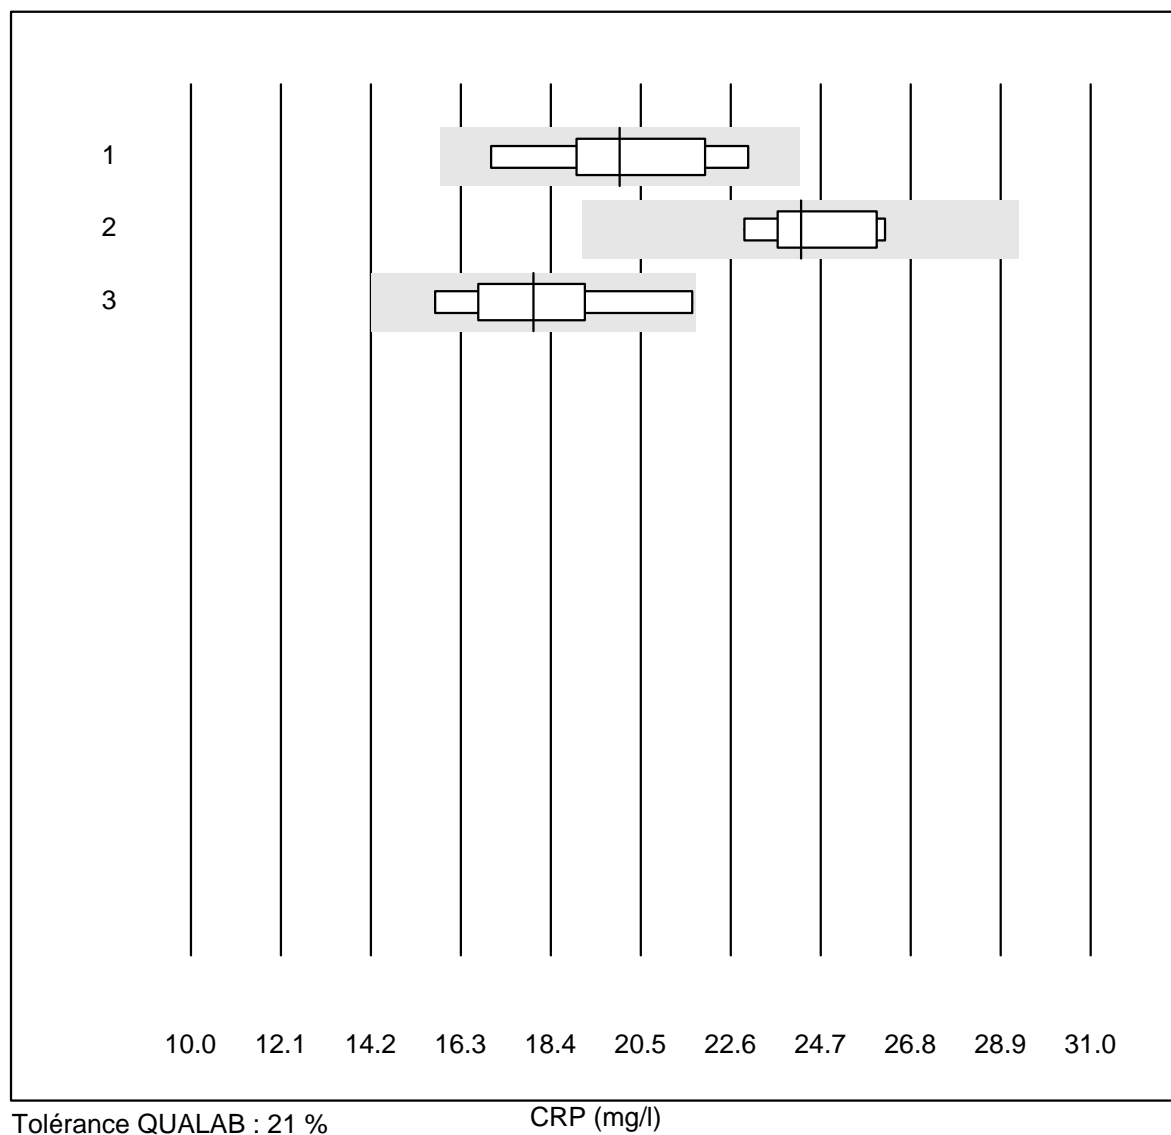

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 AQT 90 FLEX	7	100.0	0.0	0.0	20.0	9.7	e*
2 Spotchem D-Concept	5	100.0	0.0	0.0	24.2	5.9	e*
3 Spotchem SI-3510	5	100.0	0.0	0.0	18.0	12.8	e*

IgG

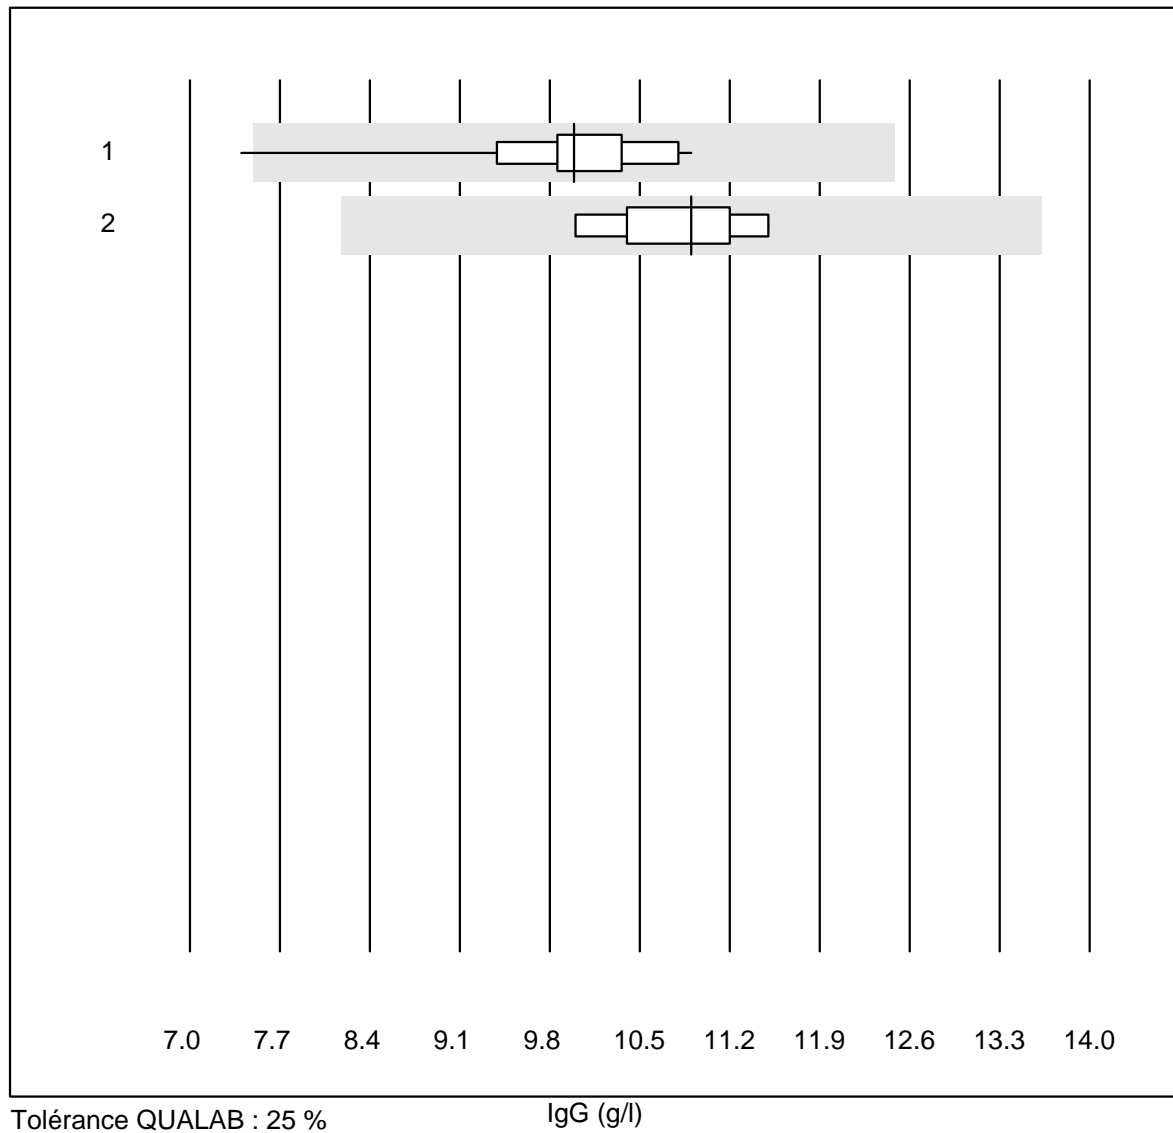


Tolérance QUALAB : 25 %

IgG (g/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Turbidimétrie	12	91.7	8.3	0.0	10.0	9.1	e
2 Néphélométrie	8	100.0	0.0	0.0	10.9	4.9	e

IgA

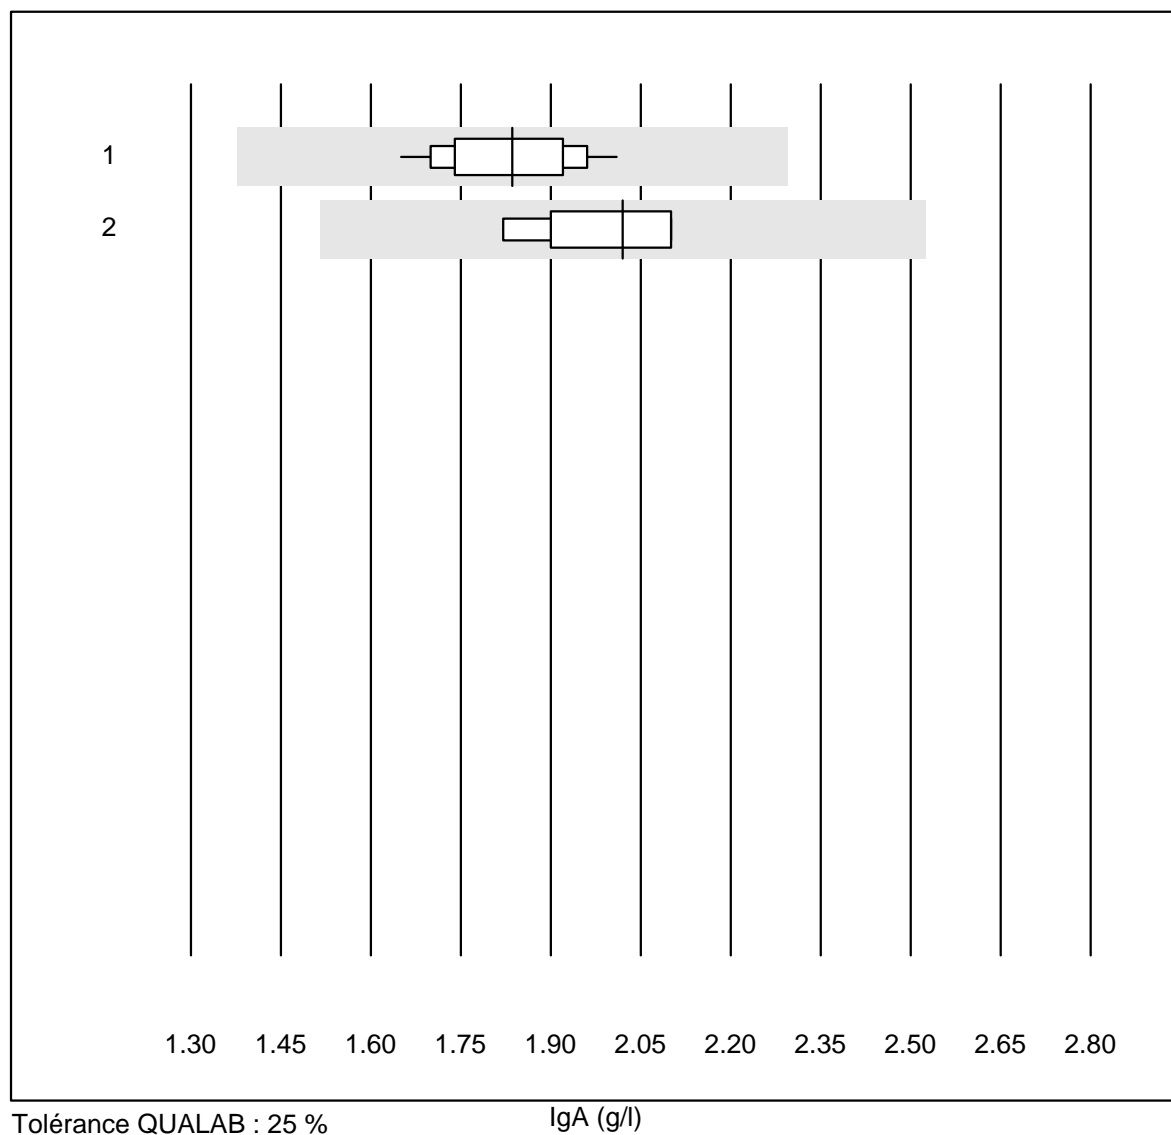


Tolérance QUALAB : 25 %

IgA (g/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Turbidimétrie	12	100.0	0.0	0.0	1.8	6.2	e
2 Néphélométrie	8	100.0	0.0	0.0	2.0	5.1	e

IgM

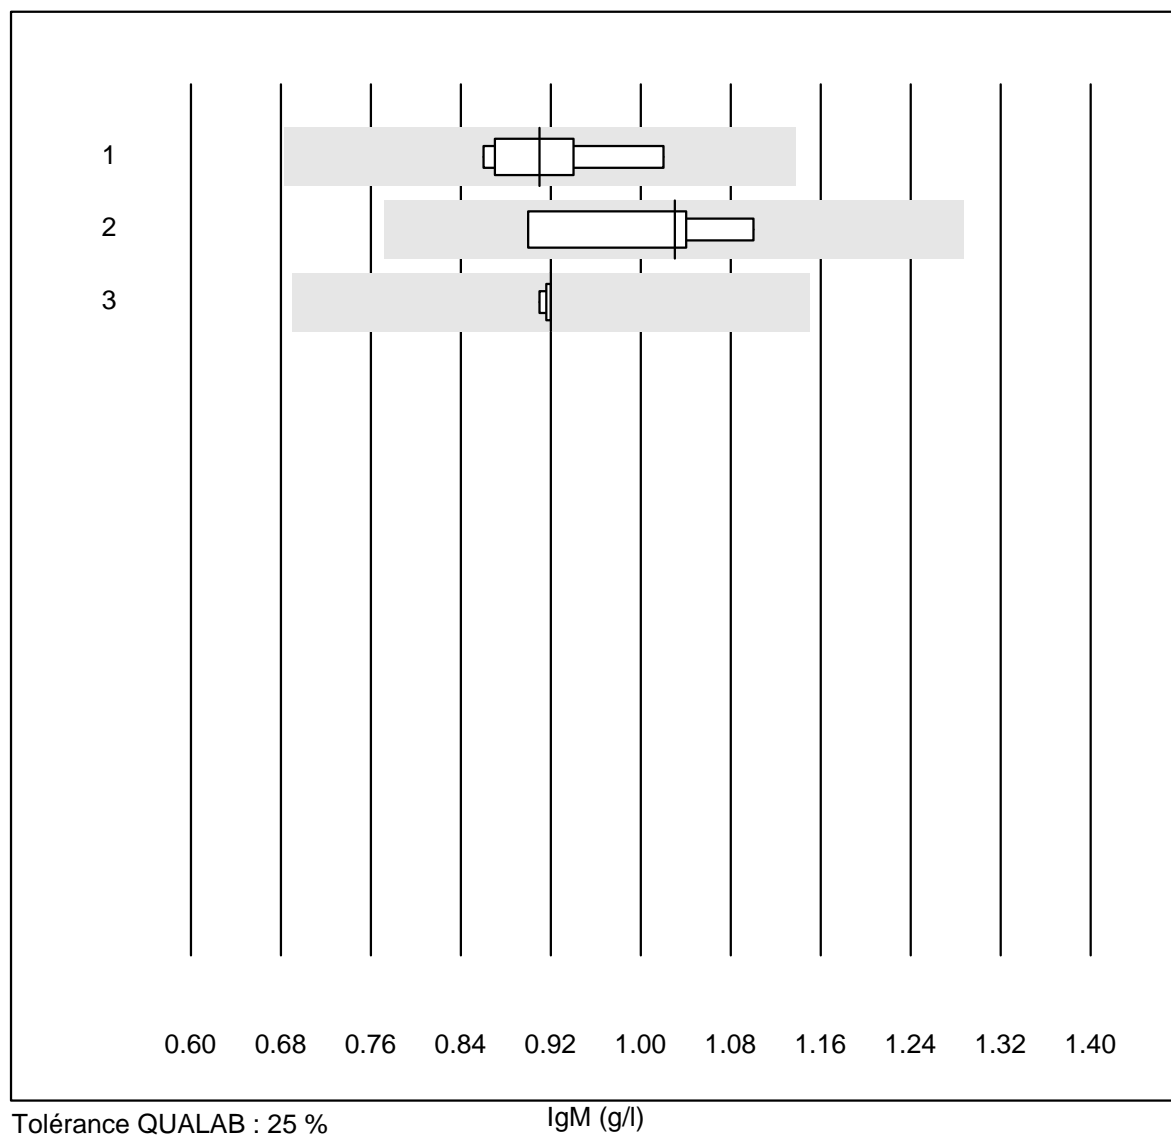

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Turbidimétrie	7	85.7	0.0	14.3	0.9	6.3	e
2	Nephelométrie	8	100.0	0.0	0.0	1.0	7.4	e
3	Cobas Integra 800/40	5	100.0	0.0	0.0	0.9	0.5	e

IgE

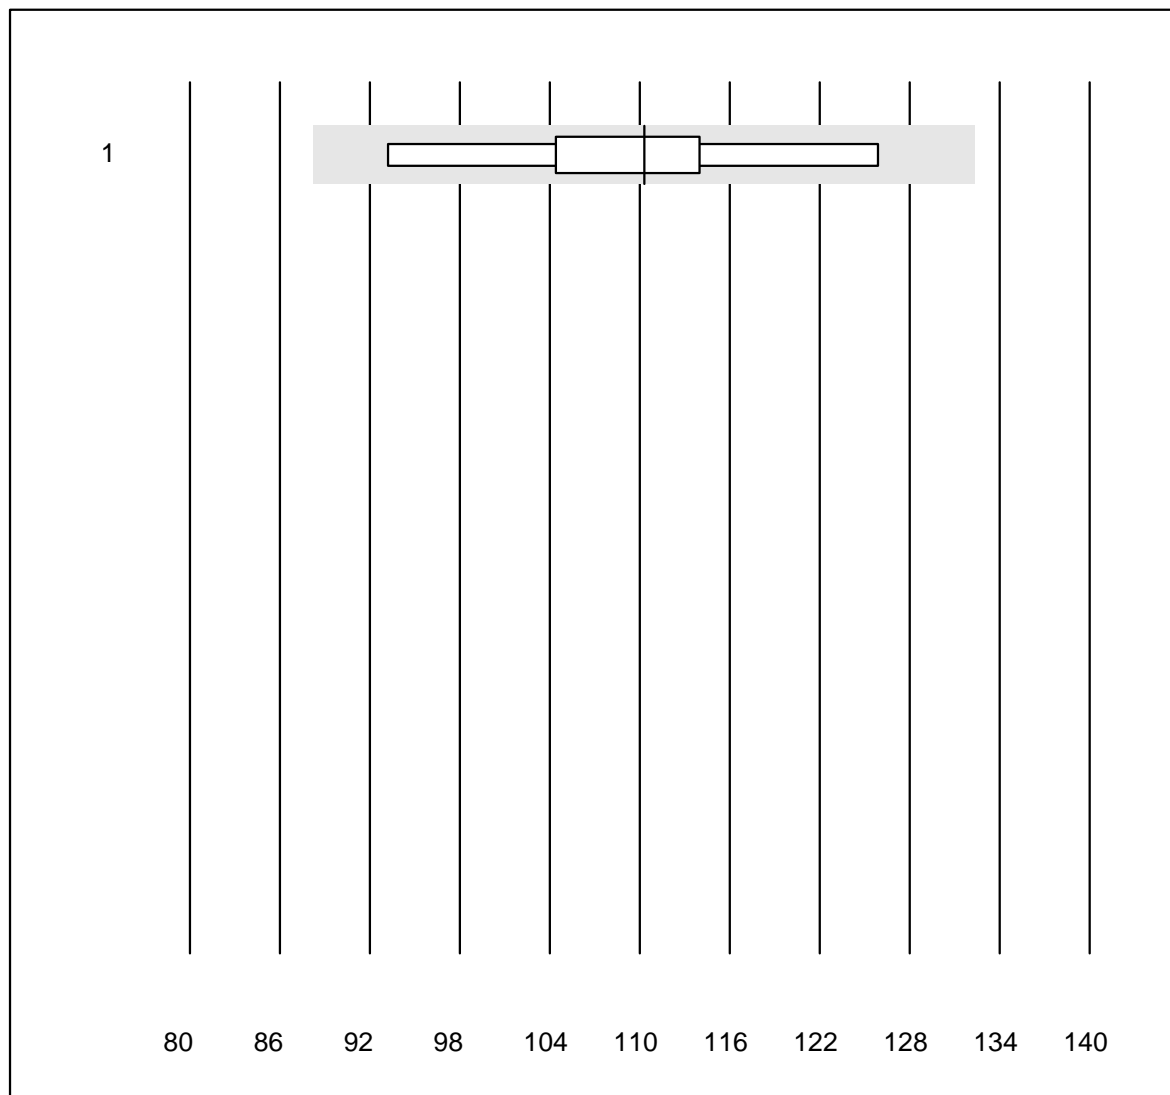


Tolérance QUALAB : 20 %

IgE (kU/L)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	10	90.0	0.0	10.0	110	8.6	e*

Alpha-1-Antitrypsine

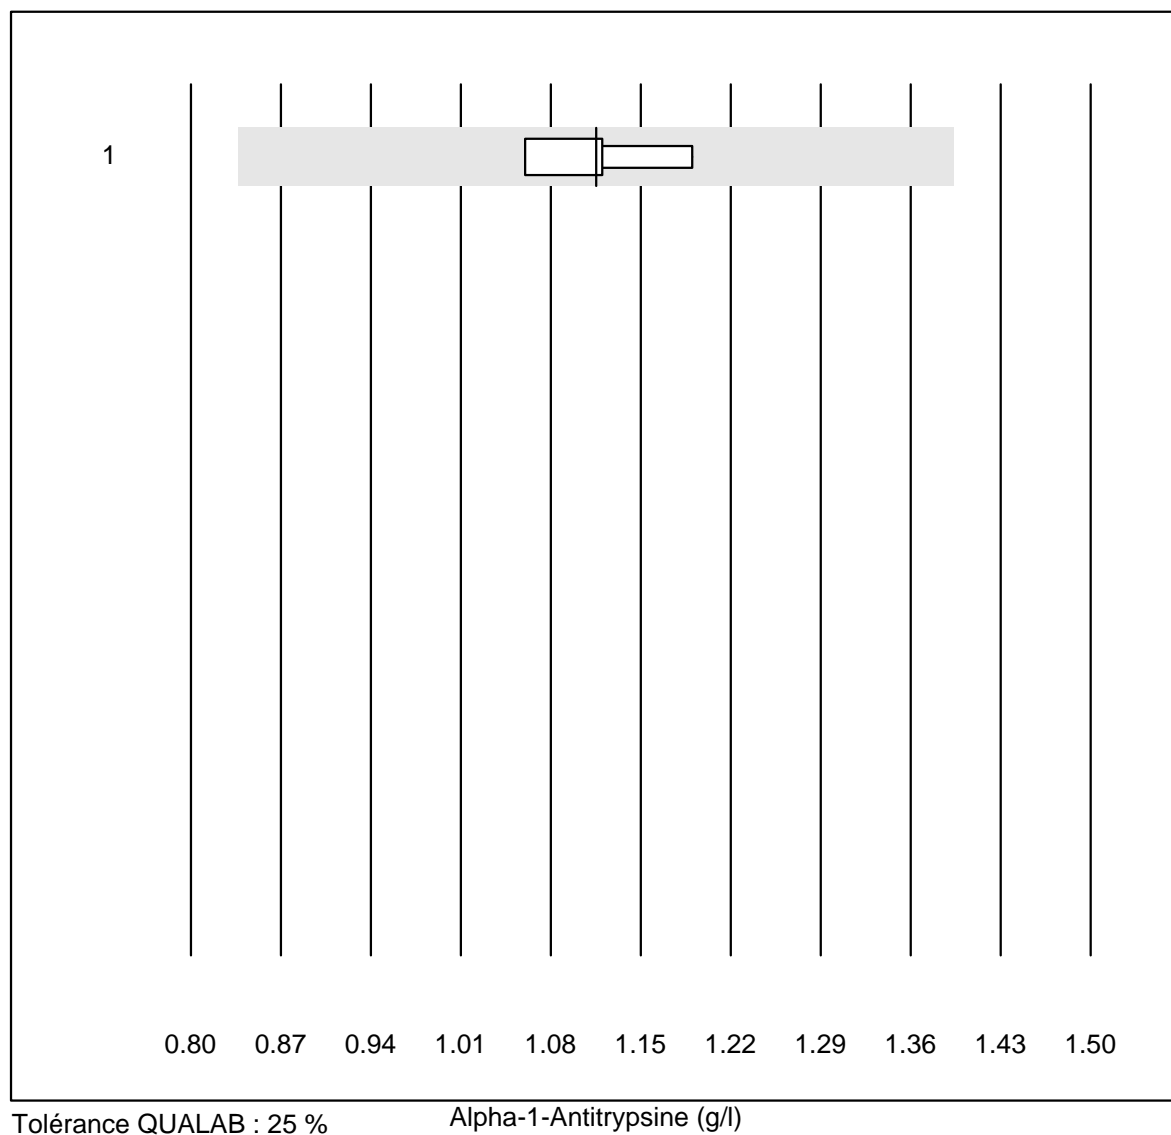

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Nephelometrie	4	100.0	0.0	0.0	1.12	4.8	e


Anti-Streptolysine-Anticorps

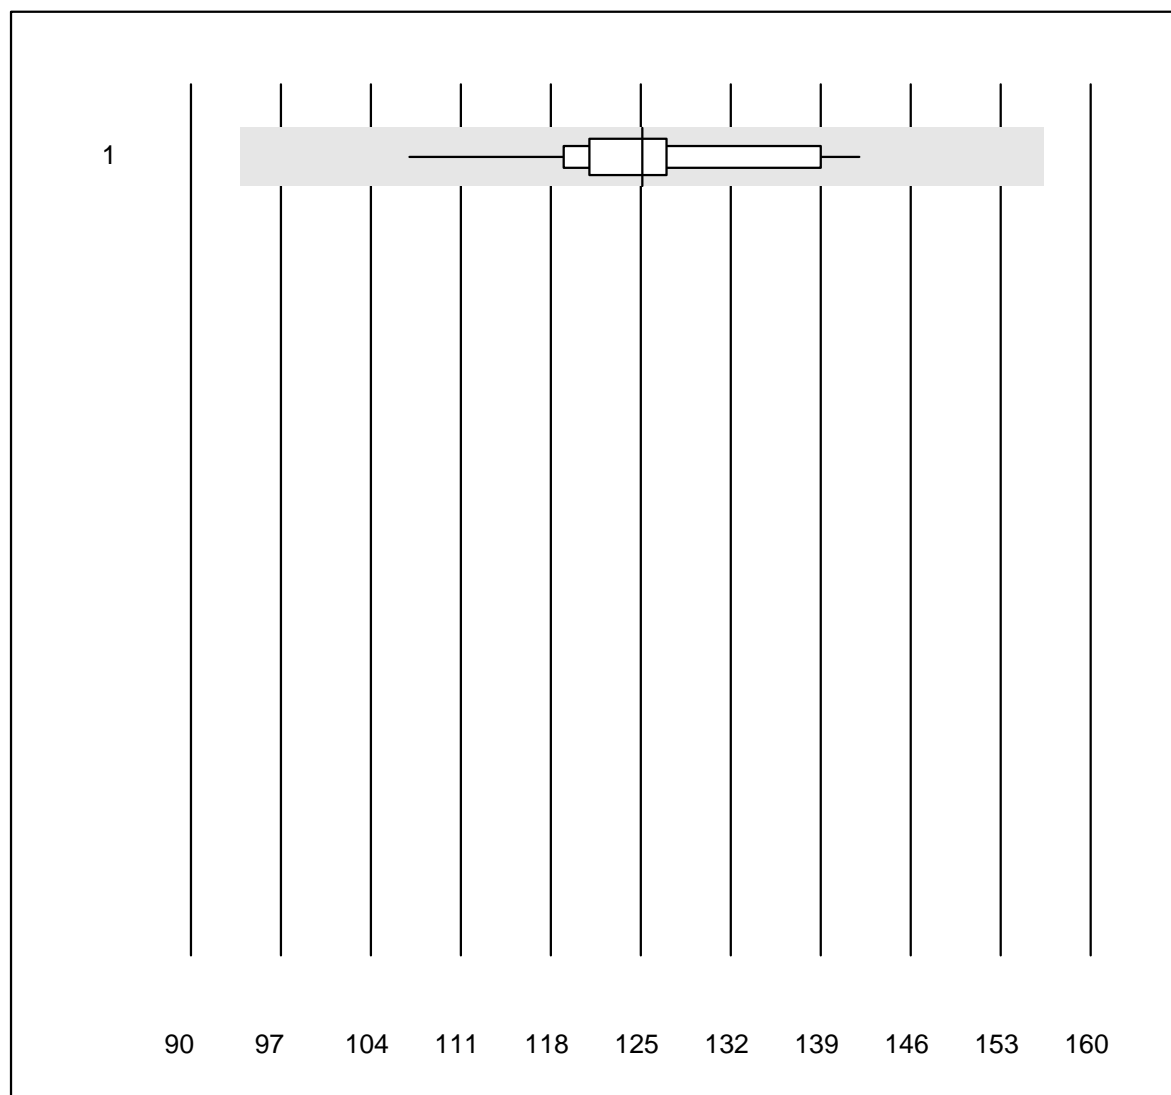

Tolérance QUALAB : 25 % Anti-Streptolysine-Anticorps (kIU/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	12	91.7	0.0	8.3	125	7.5	e

Complément C3

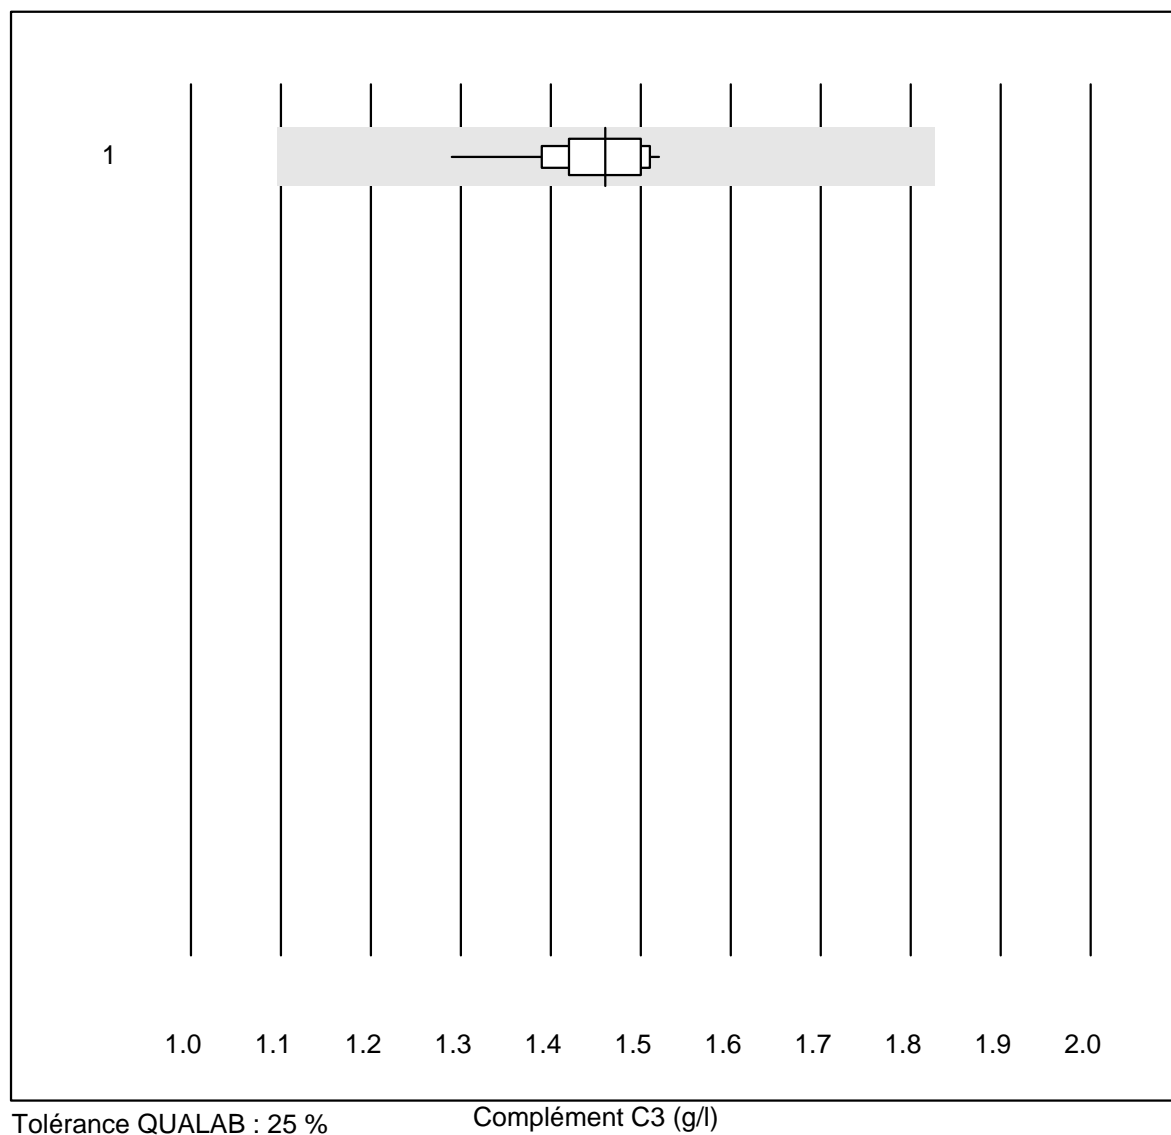


No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 toutes les méthodes	12	100.0	0.0	0.0	1.46	4.5	e

Complément C4

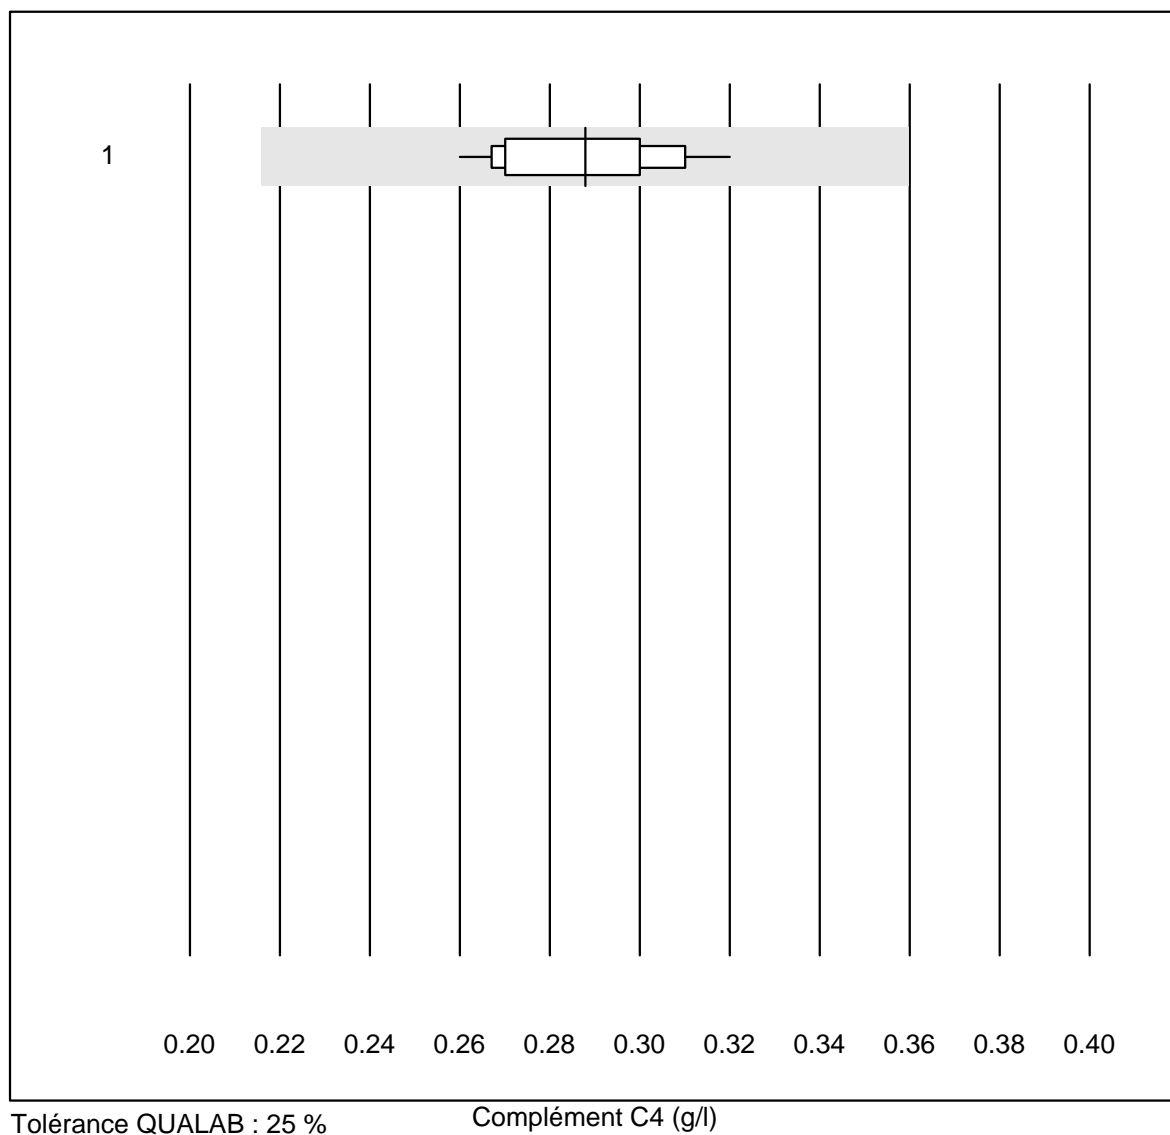


No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 toutes les méthodes	11	100.0	0.0	0.0	0.29	7.2	e

Haptoglobine

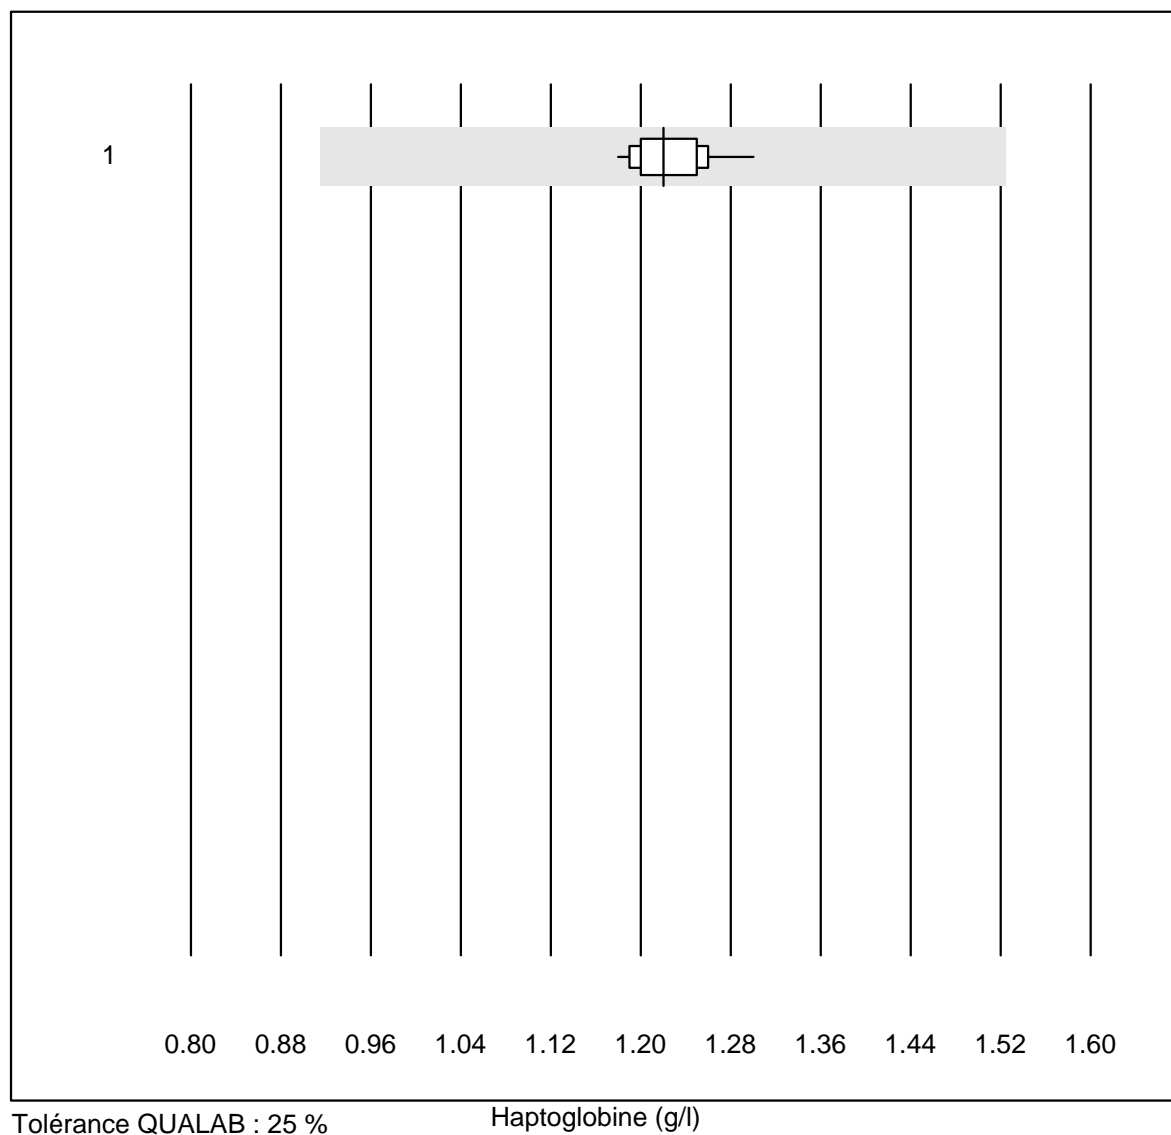


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	13	100.0	0.0	0.0	1.22	2.9	e

Transferrine

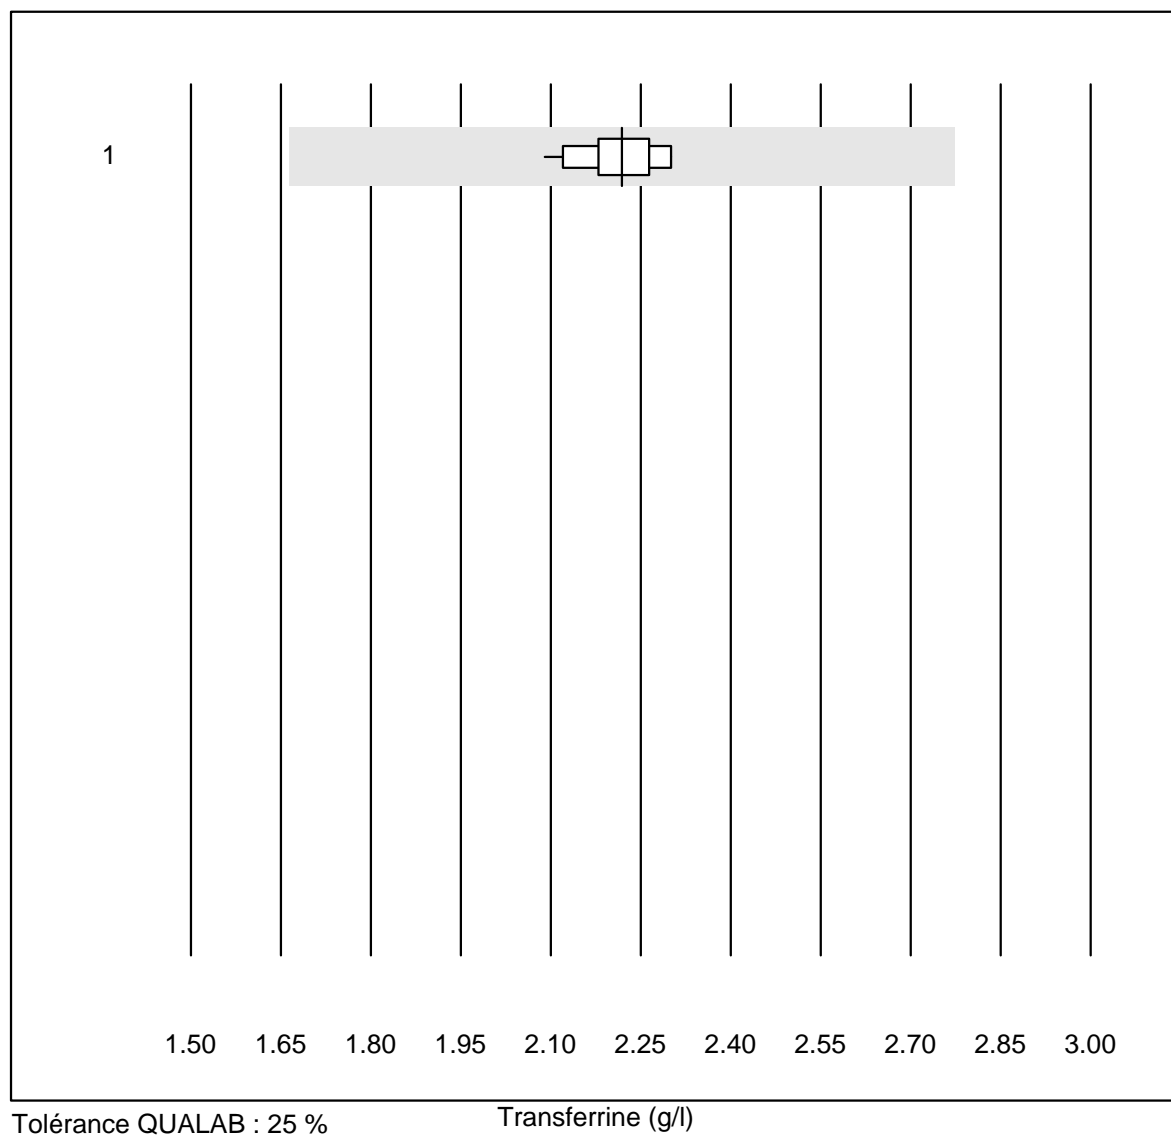

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 toutes les méthodes	22	100.0	0.0	0.0	2.22	2.9	e

Beta-2-Mikroglobulin

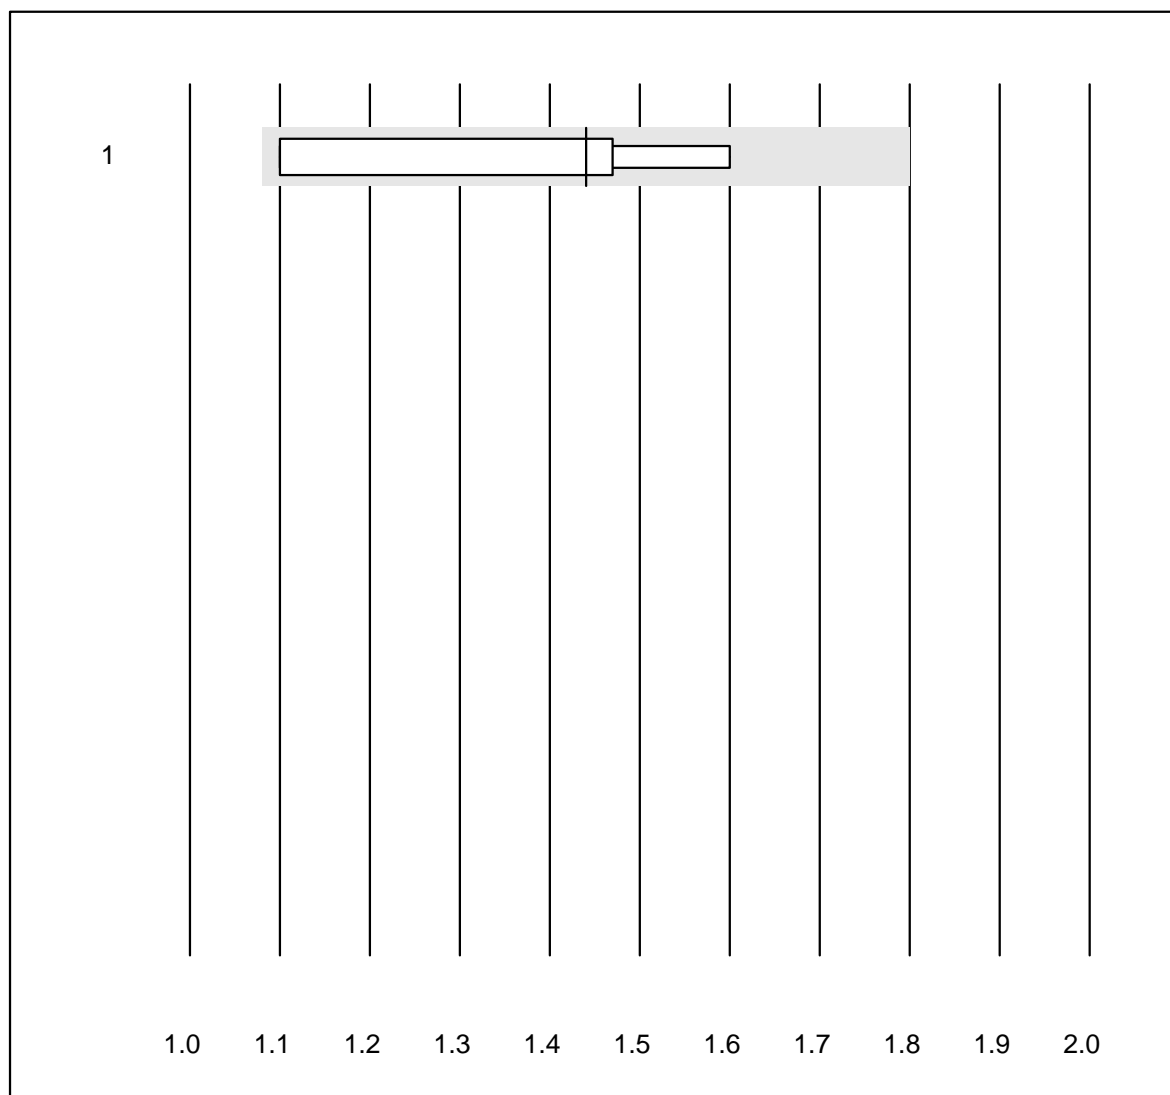


Tolérance QUALAB : 25 %

Beta-2-Mikroglobulin (mg/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	1.44	15.2	e*

Facteur rhumatoïde

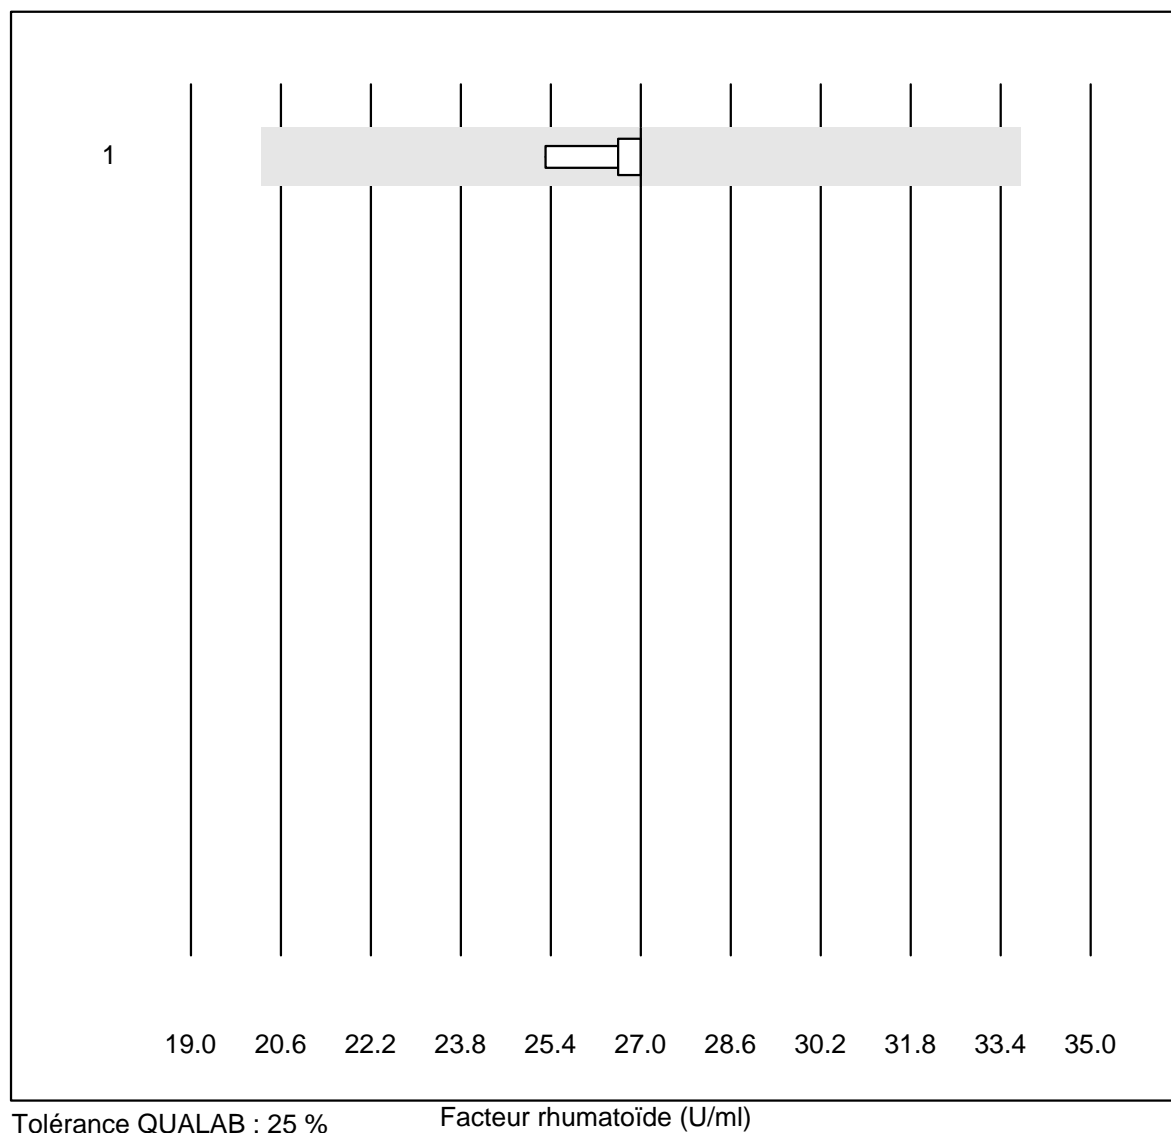


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	27.0	2.8	e

Präalbumin

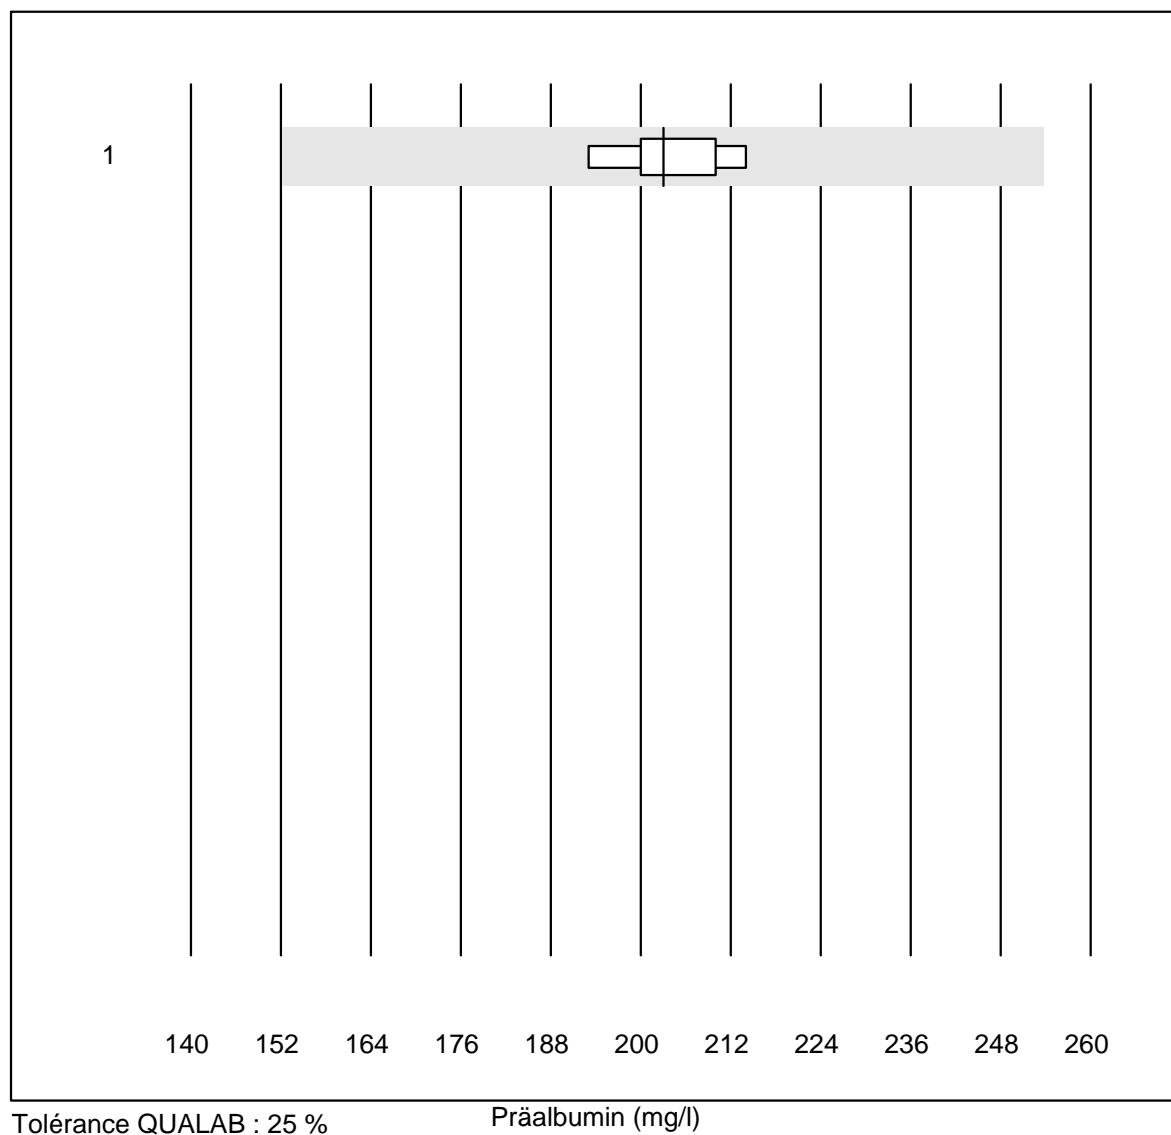


No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 toutes les méthodes	9	100.0	0.0	0.0	203.0	3.2	e

CRP

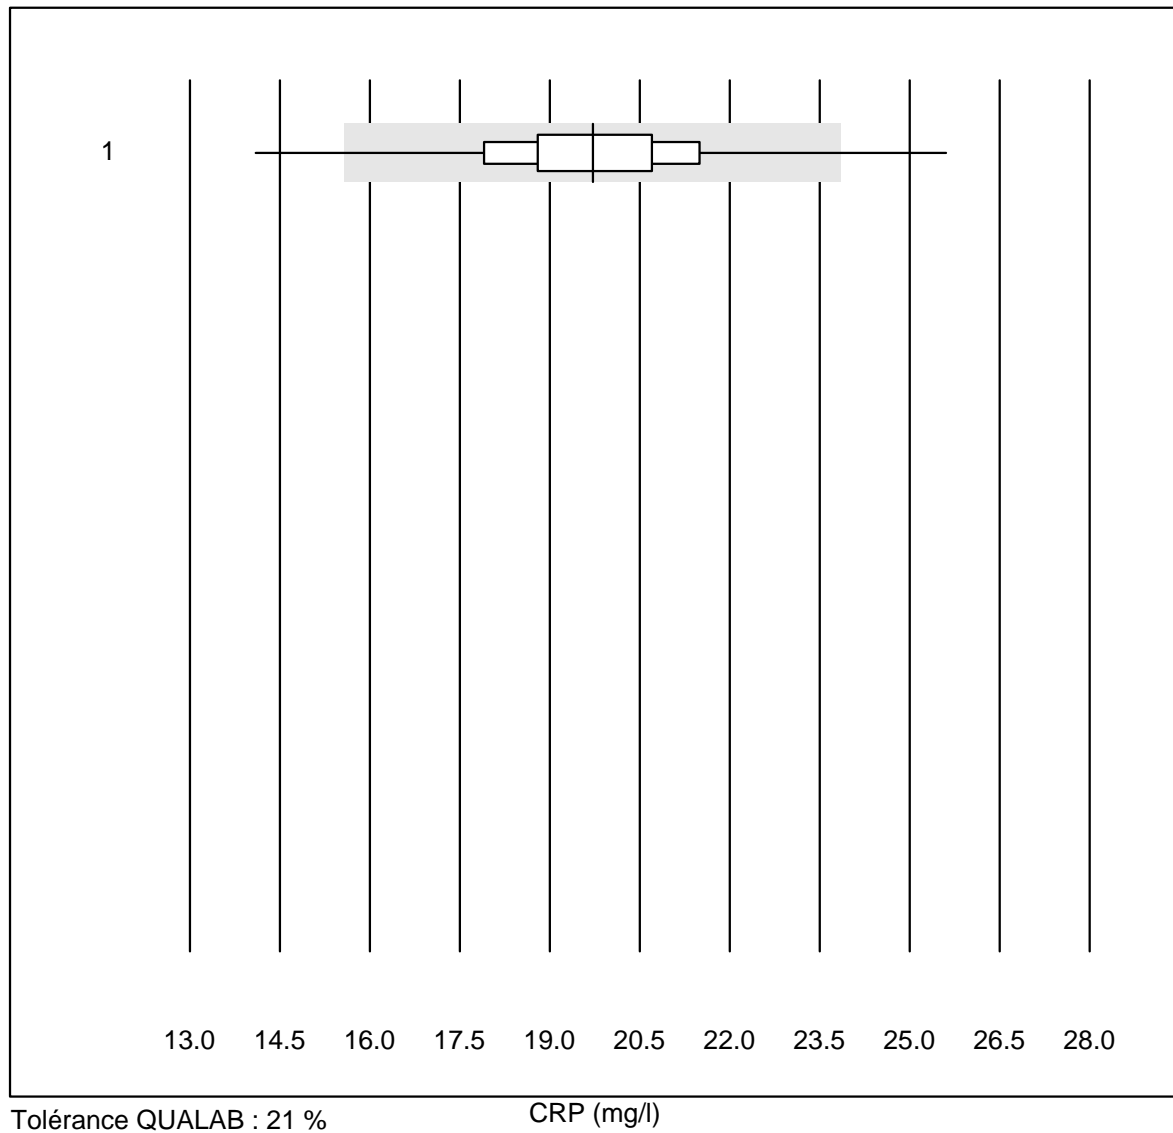

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Microsemi	487	96.1	1.2	2.7	19.7	7.8	e

Albumine

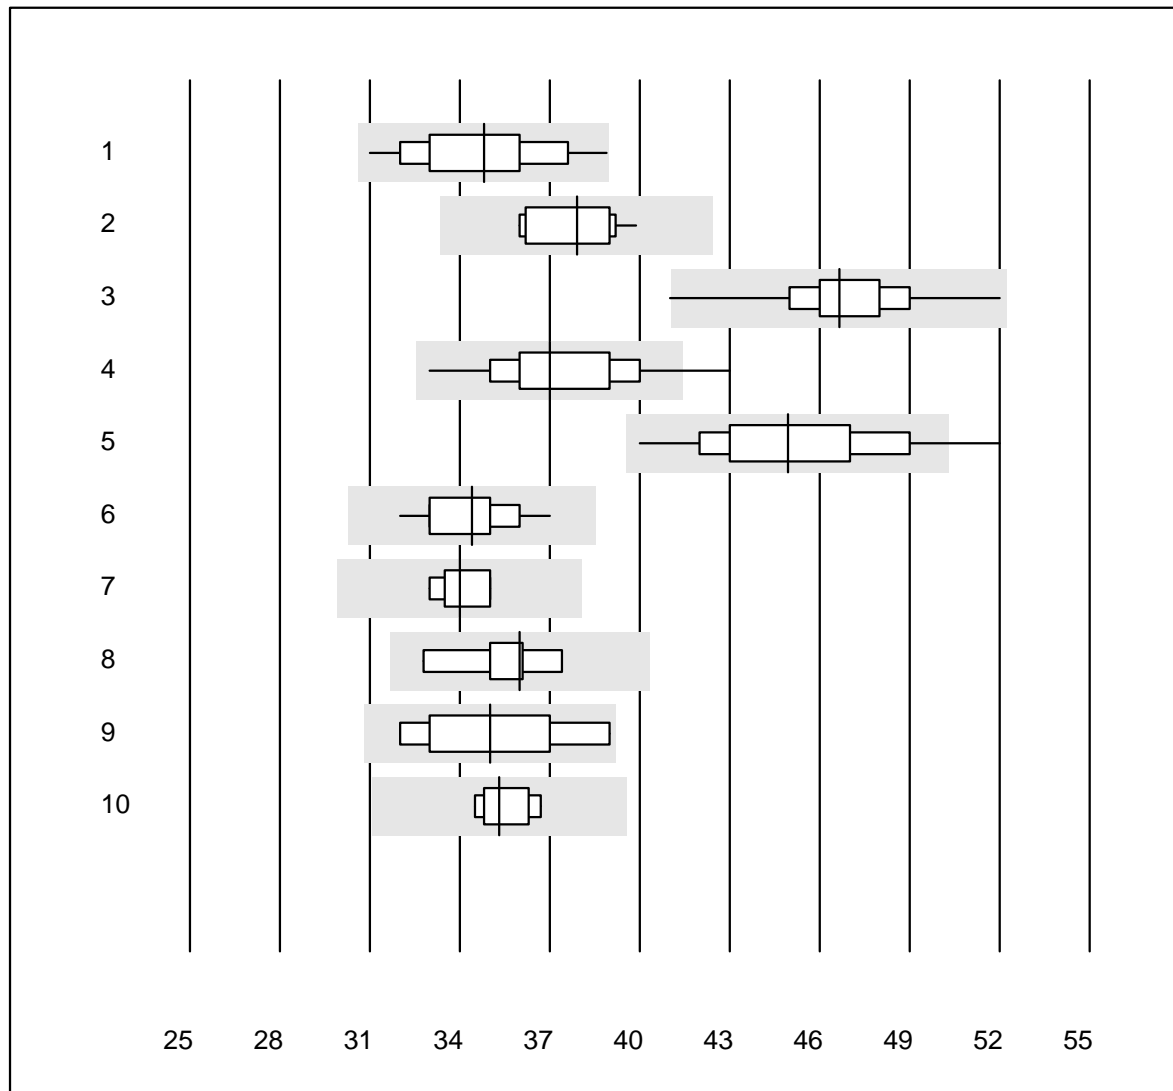


Tolérance QUALAB : 12 %

Albumine (g/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	28	100.0	0.0	0.0	35	5.6	e
2	Cobas	15	100.0	0.0	0.0	38	3.5	e
3	Fuji Dri-Chem	200	97.5	1.0	1.5	47	3.8	e
4	Spotchem/Ready	34	94.1	5.9	0.0	37	5.8	e
5	Spotchem D-Concept	101	95.0	5.0	0.0	45	6.2	e
6	Piccolo	37	100.0	0.0	0.0	34	3.7	e
7	Skyla	5	100.0	0.0	0.0	34	2.6	e
8	Abx Mira	5	100.0	0.0	0.0	36	4.8	e*
9	Hitachi S40/M40	8	100.0	0.0	0.0	35	6.9	e*
10	Autolyser/DiaSys	7	100.0	0.0	0.0	35	2.3	e

Phosphatase alcaline

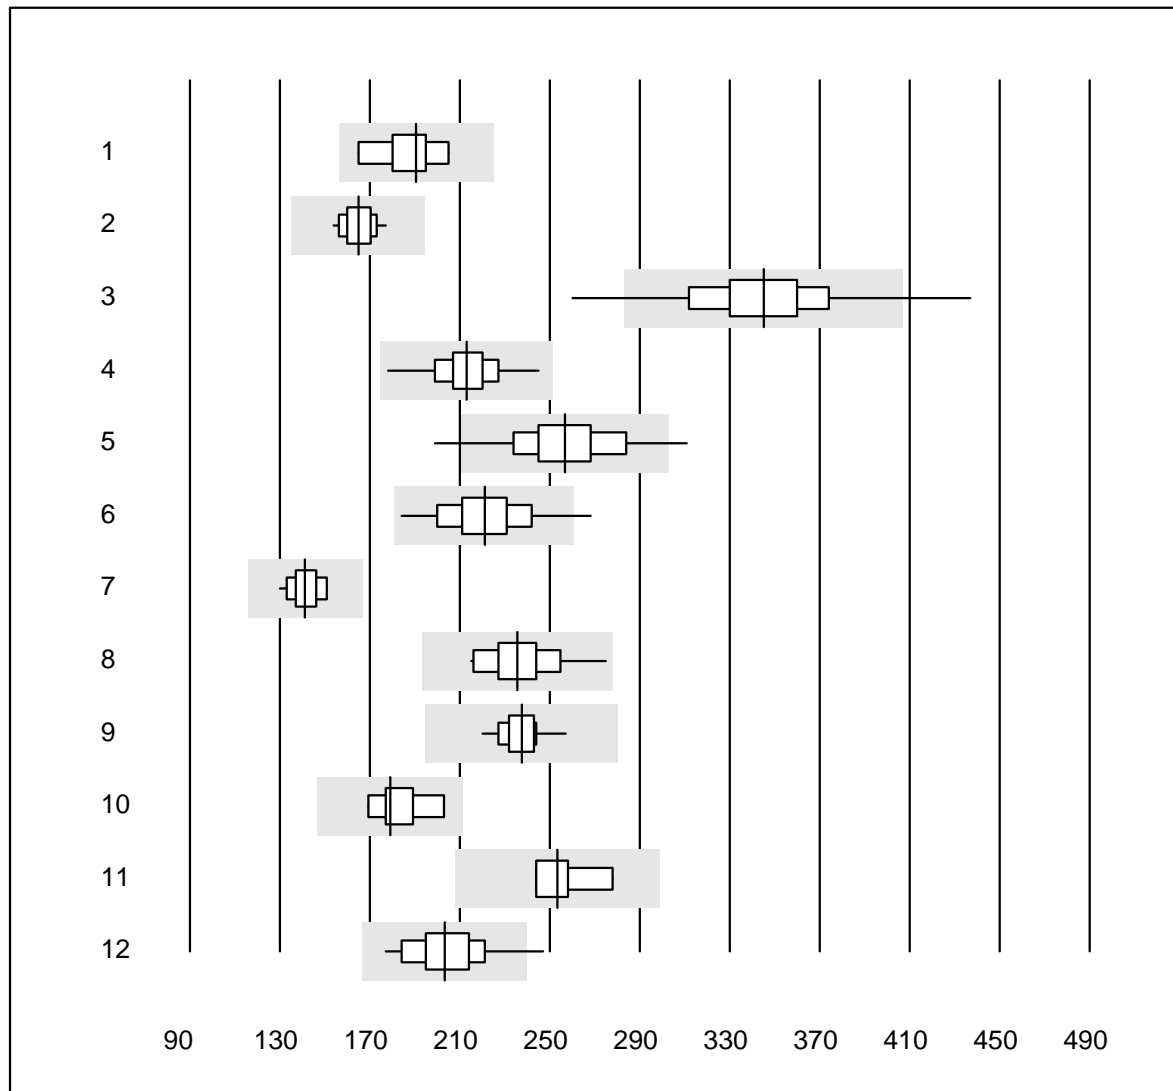


Tolérance QUALAB : 18 %

Phosphatase alcaline (U/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 IFCC	8	100.0	0.0	0.0	191	6.8	e*
2 Cobas	18	100.0	0.0	0.0	165	3.9	e
3 Reflotron	608	95.7	3.3	1.0	345	7.7	e
4 Fuji Dri-Chem	723	99.9	0.0	0.1	213	5.1	e
5 Spotchem/Ready	88	96.6	2.3	1.1	257	7.7	e
6 Spotchem D-Concept	181	98.9	1.1	0.0	221	7.2	e
7 Hitachi S40/M40	17	100.0	0.0	0.0	141	4.7	e
8 Beckman	19	100.0	0.0	0.0	235	6.4	e
9 Piccolo	33	100.0	0.0	0.0	237	3.3	e
10 Abx Mira	9	100.0	0.0	0.0	179	5.9	e
11 Skyla	4	100.0	0.0	0.0	254	5.8	e*
12 Autolyser/DiaSys	17	94.1	5.9	0.0	203	8.3	e

Amylase

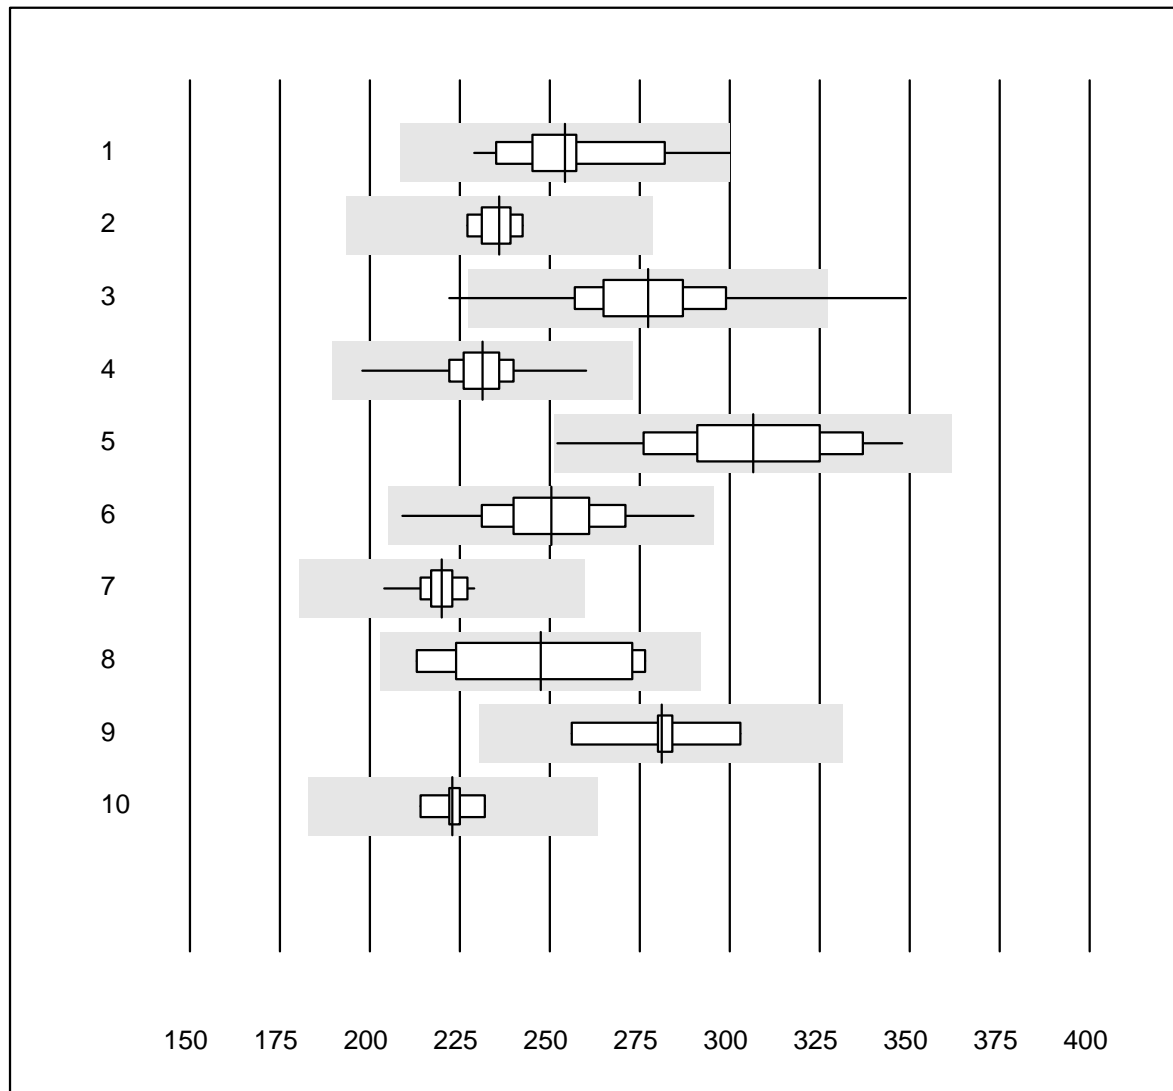


Tolérance QUALAB : 18 %

Amylase (U/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 IFCC	18	94.4	5.6	0.0	254	6.3	e
2 Cobas	6	100.0	0.0	0.0	236	2.3	e
3 Reflotron	163	97.6	1.8	0.6	277	6.5	e
4 Fuji Dri-Chem	520	100.0	0.0	0.0	231	3.4	e
5 Spotchem/Ready	57	100.0	0.0	0.0	307	7.5	e
6 Spotchem D-Concept	136	100.0	0.0	0.0	250	6.2	e
7 Piccolo	32	100.0	0.0	0.0	220	2.5	e
8 Abx Mira	6	100.0	0.0	0.0	248	11.6	e*
9 Hitachi S40/M40	9	100.0	0.0	0.0	281	4.6	e
10 Autolyser/DiaSys	5	100.0	0.0	0.0	223	2.9	e

Amylase pancréatique

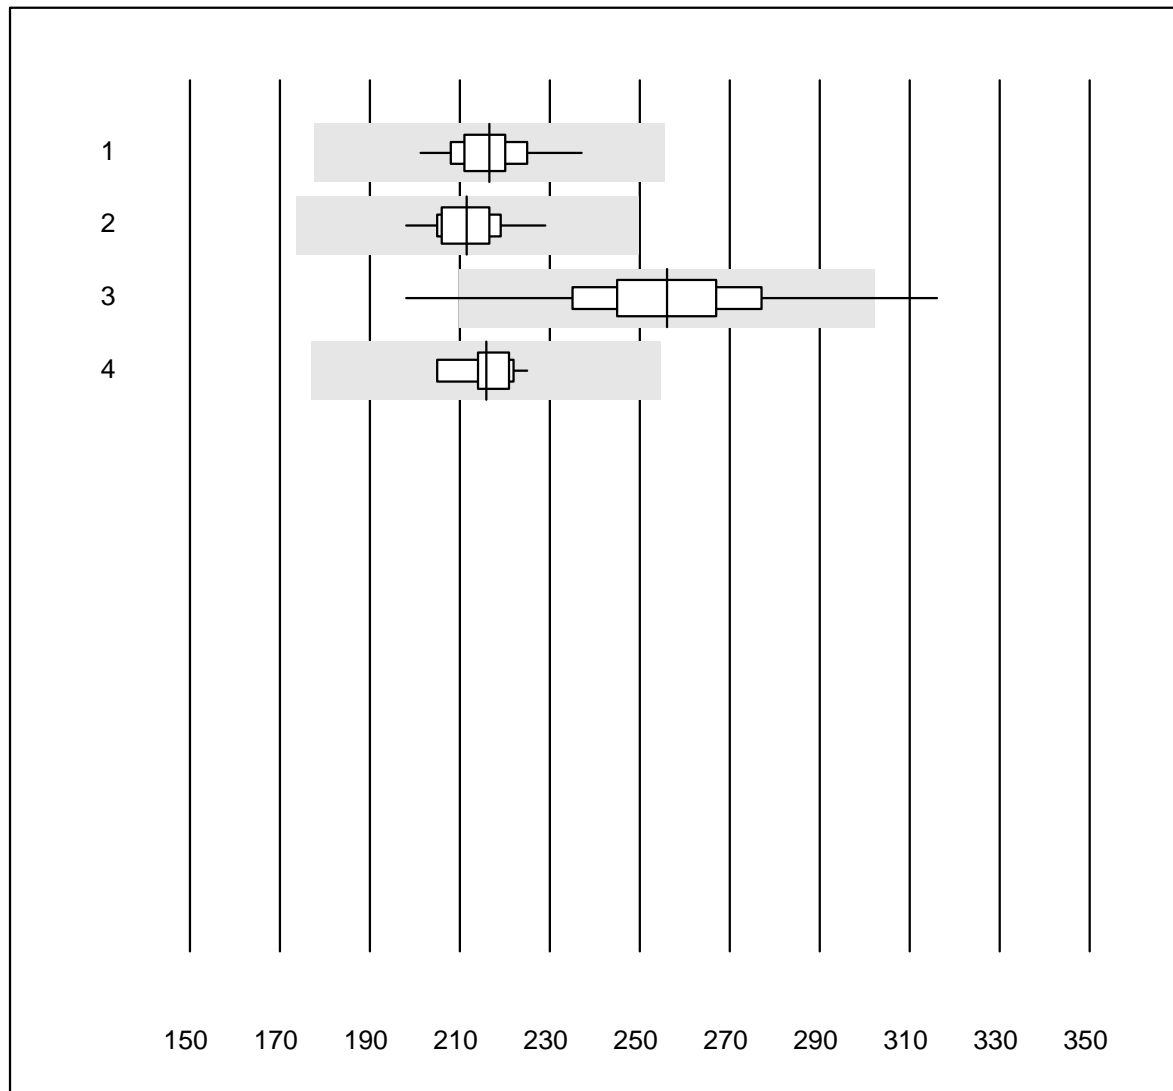


Tolérance QUALAB : 18 %

Amylase pancréatique (U/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 IFCC	21	100.0	0.0	0.0	217	3.6	e
2 Cobas	11	100.0	0.0	0.0	212	3.9	e
3 Reflotron	415	97.1	1.7	1.2	256	6.7	e
4 Autolyser/DiaSys	10	100.0	0.0	0.0	216	3.0	e

Bilirubine totale

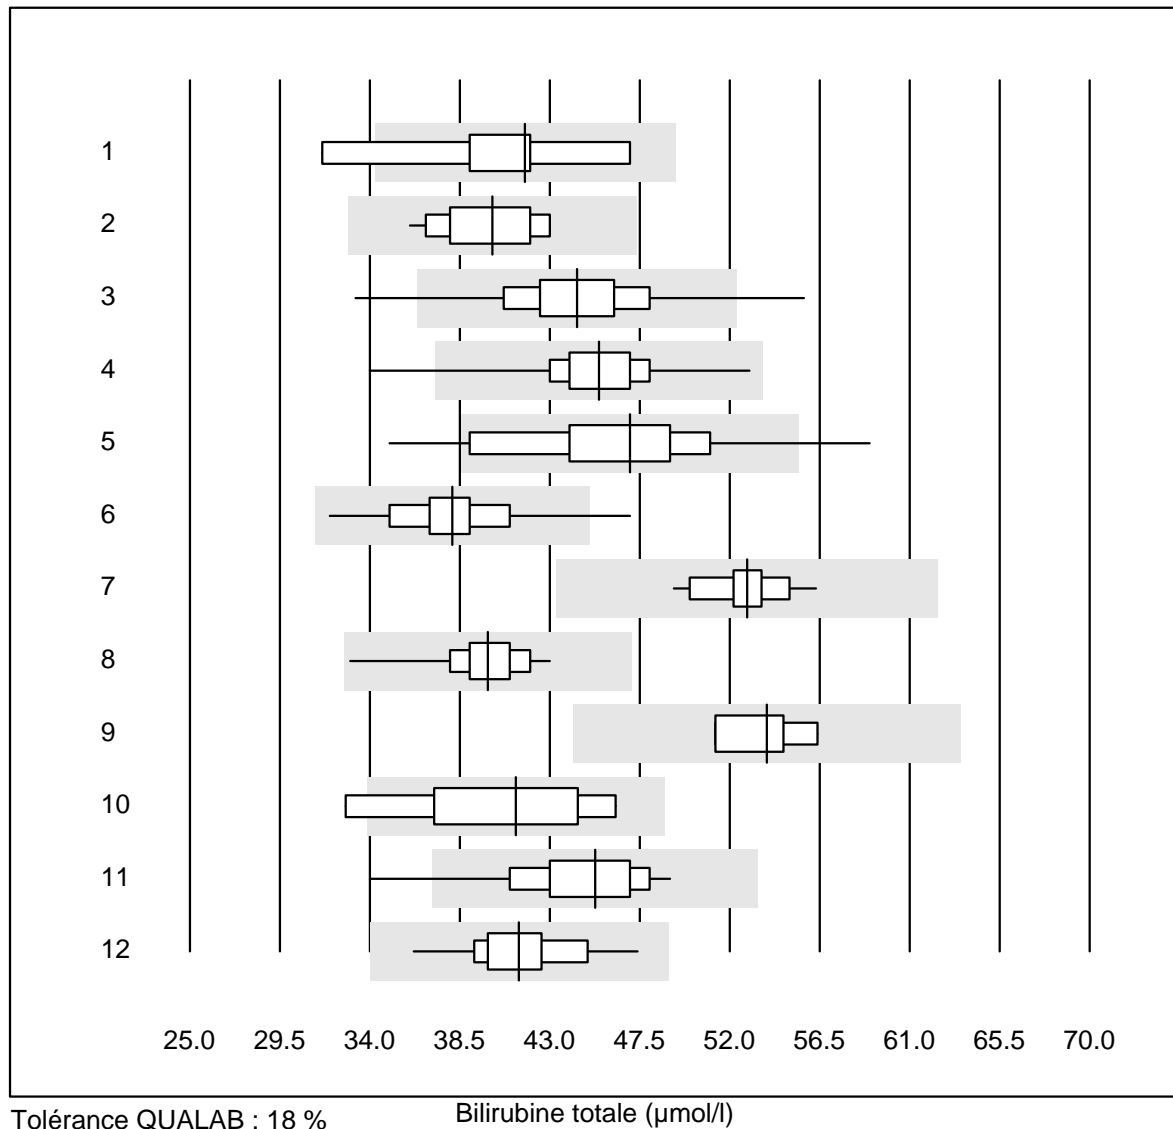

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	9	88.9	11.1	0.0	41.8	10.4	e*
2	Cobas	17	100.0	0.0	0.0	40.1	5.6	e
3	Reflotron	450	95.8	1.8	2.4	44.3	6.8	e
4	Fuji Dri-Chem	554	97.8	1.1	1.1	45.5	5.4	e
5	Spotchem/Ready	72	91.6	5.6	2.8	47.0	9.9	e
6	Spotchem D-Concept	149	96.7	1.3	2.0	38.1	6.2	e
7	Beckman	18	100.0	0.0	0.0	52.9	3.2	e
8	Piccolo	36	100.0	0.0	0.0	39.9	5.0	e
9	Skyla	4	100.0	0.0	0.0	53.9	4.1	e
10	Abx Mira	8	87.5	12.5	0.0	41.3	11.5	e*
11	Hitachi S40/M40	14	92.9	7.1	0.0	45.3	8.5	e*
12	Autolyser/DiaSys	15	100.0	0.0	0.0	41.5	6.2	e

Bilirubine directe

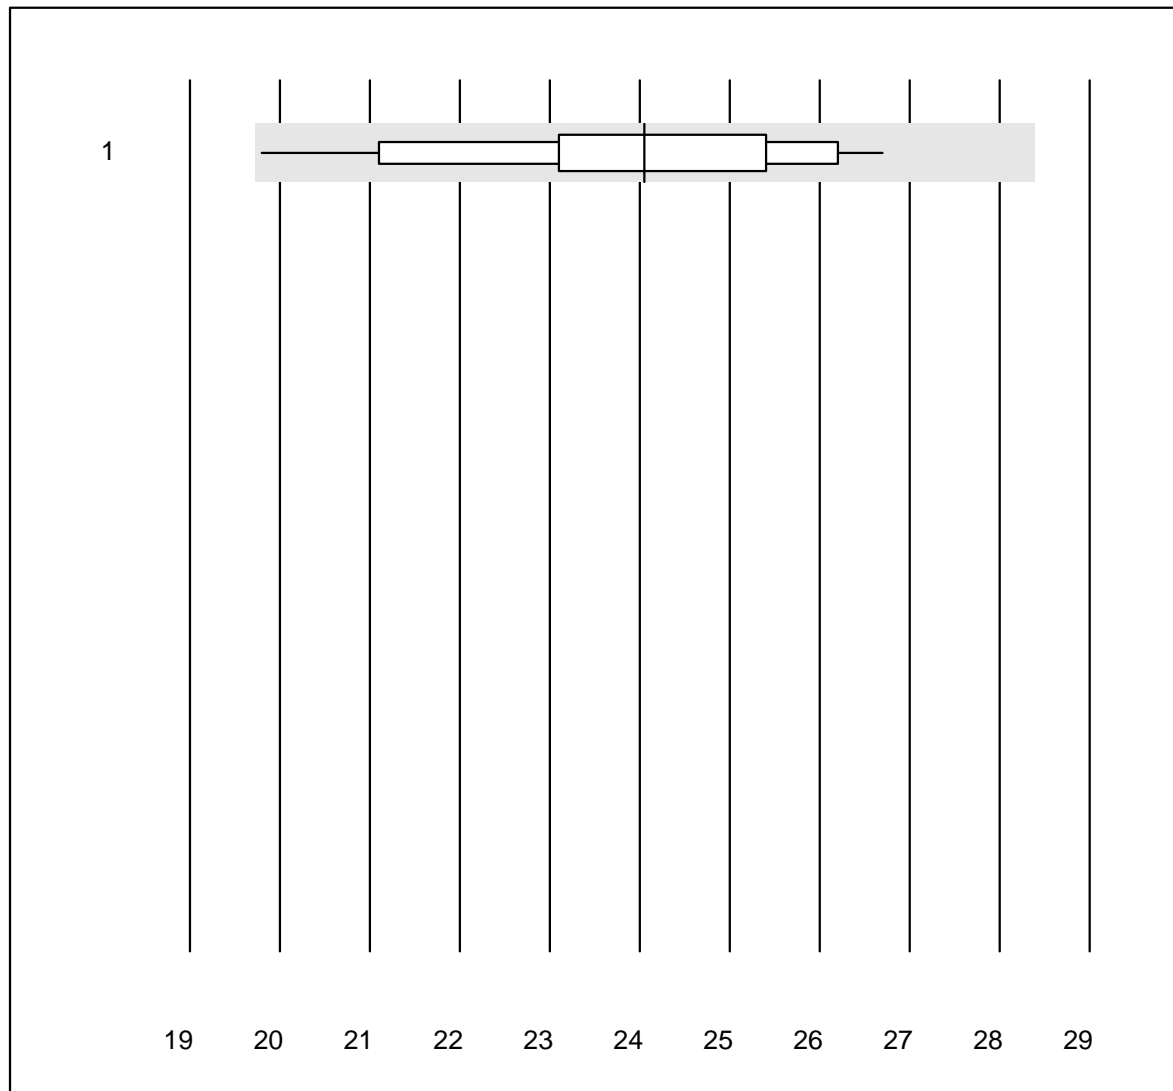


Tolérance QUALAB : 18 %

Bilirubine directe ($\mu\text{mol/l}$)

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Fuji Dri-Chem	31	90.3	0.0	9.7	24.1	7.4	e

Calcium

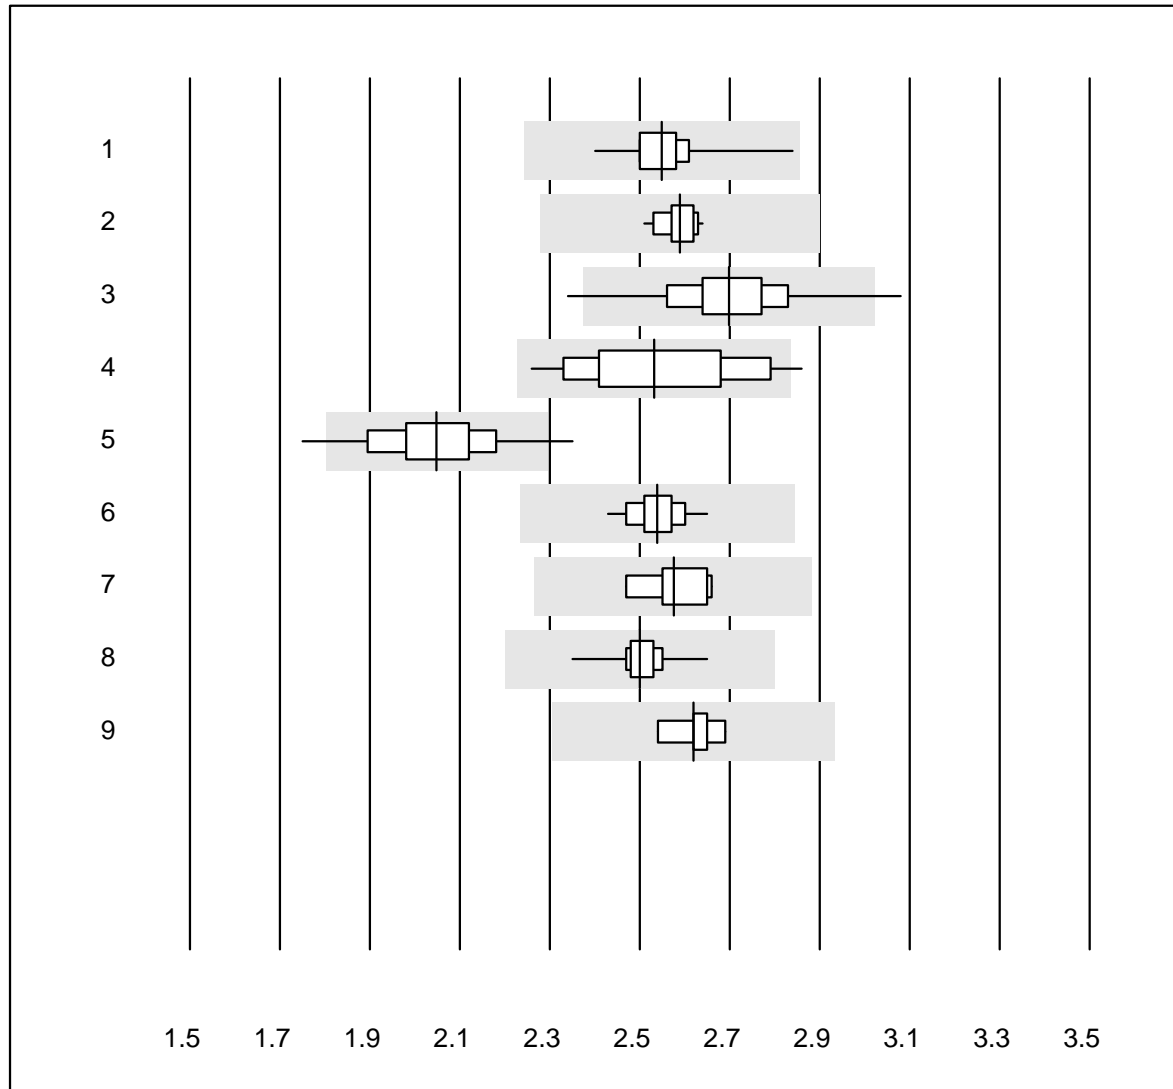


Tolérance QUALAB : 12 %

Calcium (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	31	100.0	0.0	0.0	2.55	3.3	e
2	Cobas	14	100.0	0.0	0.0	2.59	1.5	e
3	Fuji Dri-Chem	352	99.1	0.6	0.3	2.70	4.1	e
4	Spotchem/Ready	27	88.9	3.7	7.4	2.53	6.7	e
5	Spotchem D-Concept	77	89.6	9.1	1.3	2.05	6.0	e
6	Piccolo	36	100.0	0.0	0.0	2.54	1.9	e
7	Abx Mira	6	100.0	0.0	0.0	2.58	2.7	e
8	Hitachi S40/M40	12	100.0	0.0	0.0	2.50	2.7	e
9	Autolyser/DiaSys	9	100.0	0.0	0.0	2.62	1.8	e

Calcium ISE

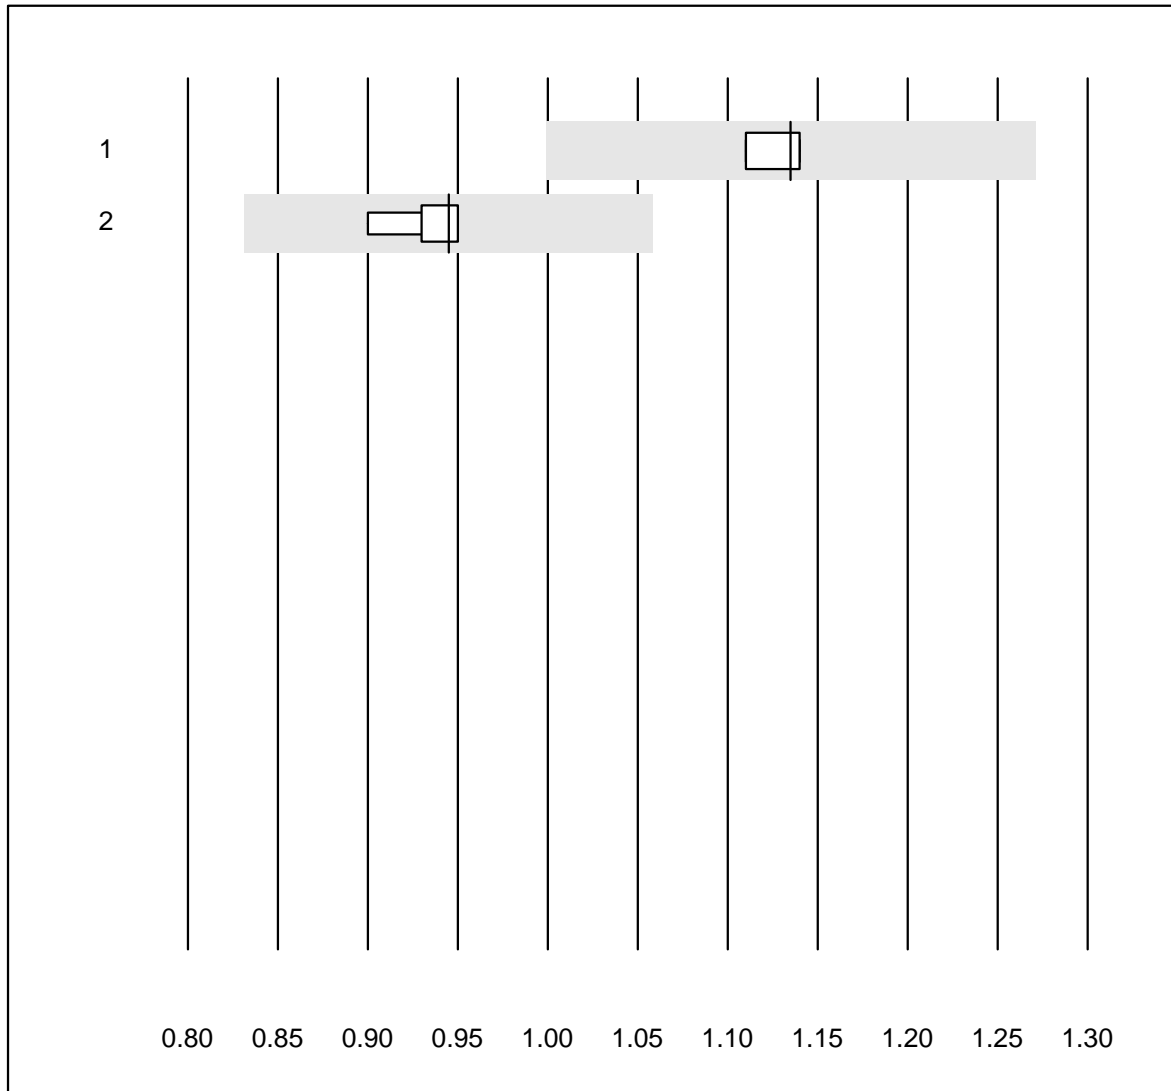


Tolérance QUALAB : 12 %

Calcium ISE (mmol/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ISE direct	4	100.0	0.0	0.0	1.14	1.3	e
2 iStat Chem8	6	83.3	0.0	16.7	0.95	2.2	e

Chlorures

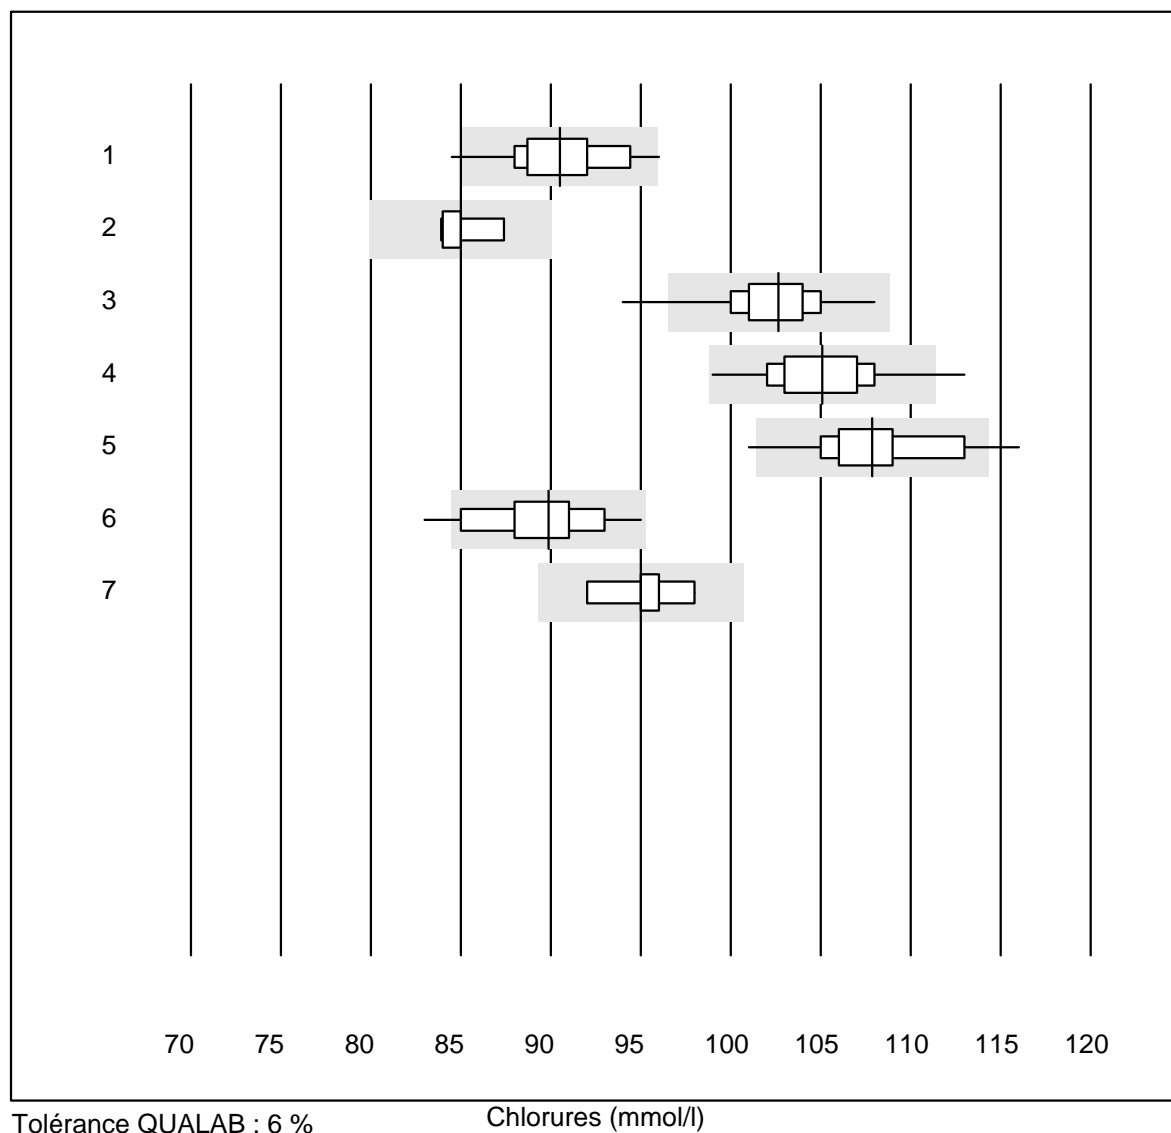


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ISE	31	93.5	6.5	0.0	91	2.9	e
2 Cobas	7	100.0	0.0	0.0	85	1.4	e
3 Fuji Dri-Chem	665	96.0	2.6	1.4	103	2.2	e
4 Spotchem D-Concept	171	97.0	1.2	1.8	105	2.3	e
5 Spotchem EL-SE 1520	104	90.4	3.8	5.8	108	2.7	e
6 Piccolo	18	94.4	5.6	0.0	90	3.2	e*
7 iStat Chem8	6	100.0	0.0	0.0	95	2.0	e*

Cholestérol

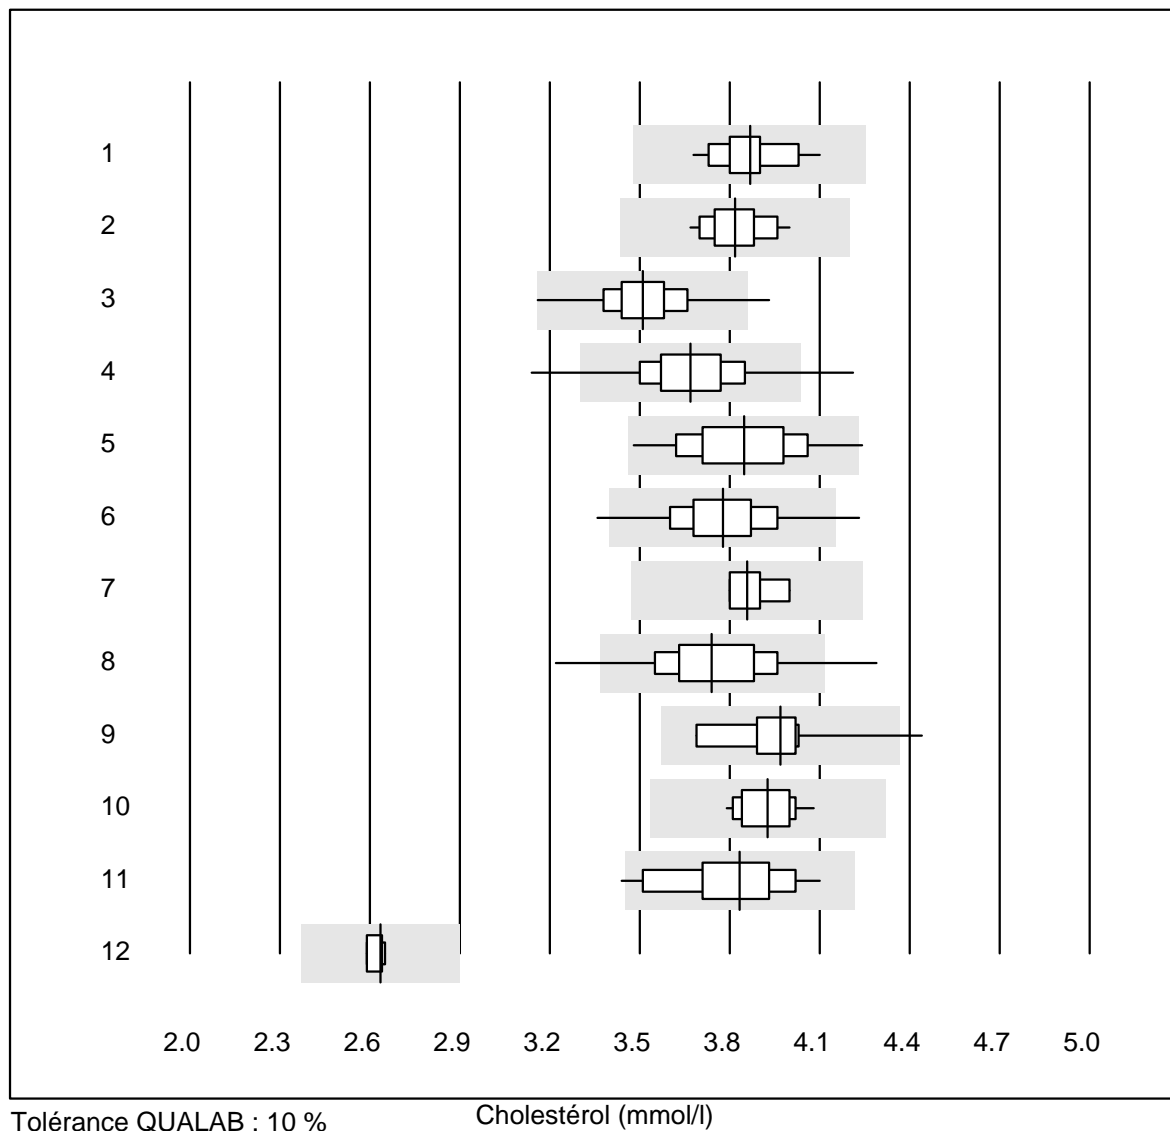

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	28	100.0	0.0	0.0	3.87	2.7	e
2	Cobas	16	100.0	0.0	0.0	3.82	2.4	e
3	Reflotron	637	98.6	0.3	1.1	3.51	3.3	e
4	Fuji Dri-Chem	729	97.6	1.9	0.5	3.67	4.0	e
5	Spotchem/Ready	115	99.1	0.9	0.0	3.85	4.5	e
6	Spotchem D-Concept	189	96.8	1.6	1.6	3.78	3.7	e
7	Piccolo	21	90.5	0.0	9.5	3.86	1.8	e
8	Cholestech LDX	179	93.8	2.8	3.4	3.74	4.7	e
9	Abx Mira	10	90.0	10.0	0.0	3.97	4.9	e*
10	Hitachi S40/M40	16	93.7	0.0	6.3	3.93	2.3	e
11	Autolyser/DiaSys	16	93.7	6.3	0.0	3.83	4.8	e*
12	Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	2.64	1.0	e

Cholestérol HDL

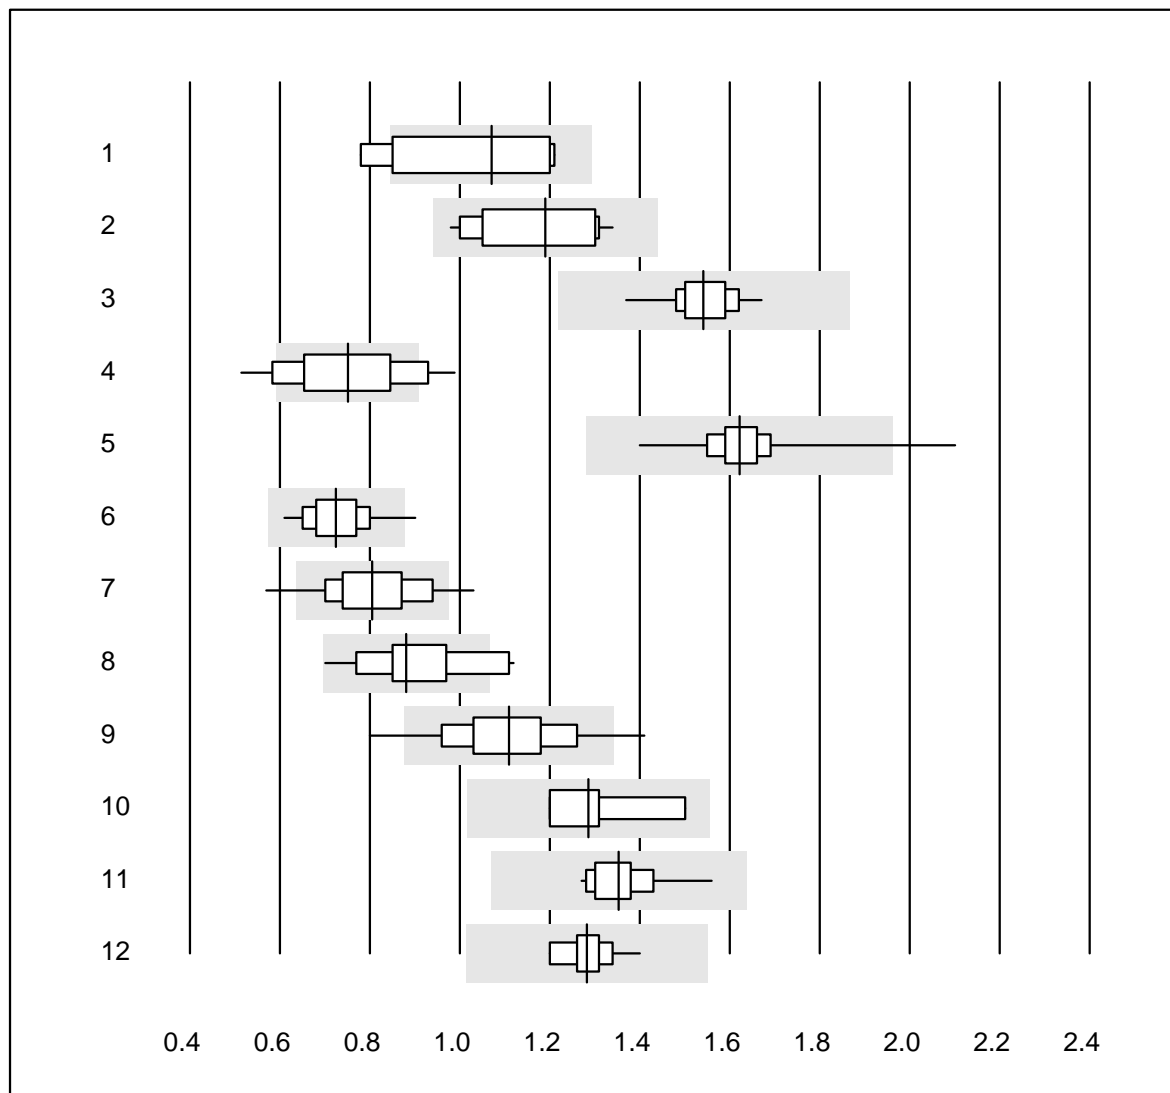


Tolérance QUALAB : 21 %

Cholestérol HDL (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Pentra/Selectra	7	85.7	14.3	0.0	1.07	17.6	e*
2	humide, direct	21	100.0	0.0	0.0	1.19	11.1	e
3	Cobas	15	100.0	0.0	0.0	1.54	4.6	e
4	Reflotron	469	56.7	19.2	24.1	0.75	16.7	e
5	Fuji Dri-Chem	697	99.3	0.1	0.6	1.62	3.6	e
6	Spotchem/Ready	101	97.0	2.0	1.0	0.73	8.3	e
7	Spotchem D-Concept	187	89.3	6.4	4.3	0.81	11.5	e
8	Piccolo	20	80.0	10.0	10.0	0.88	12.6	e*
9	Cholestech LDX	178	87.1	10.7	2.2	1.11	11.1	e
10	Abx Mira	4	100.0	0.0	0.0	1.29	9.8	e*
11	Hitachi S40/M40	15	100.0	0.0	0.0	1.35	5.3	e
12	Autolyser/DiaSys	16	100.0	0.0	0.0	1.28	3.9	e

Créatine-kinase

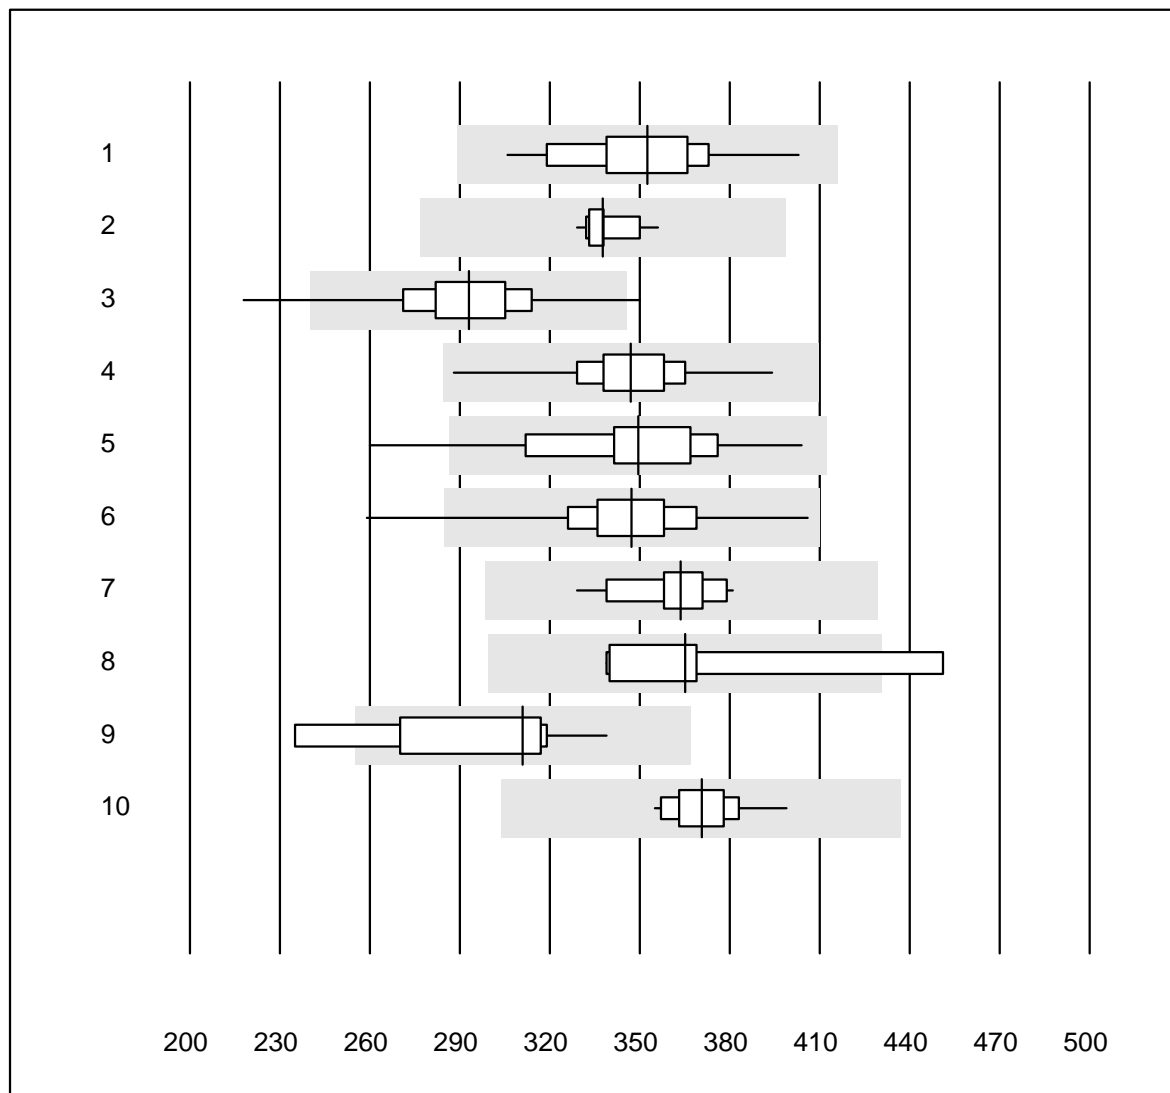


Tolérance QUALAB : 18 %

Créatine-kinase (U/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	IFCC	29	100.0	0.0	0.0	353	5.9	e
2	Cobas	15	100.0	0.0	0.0	338	2.2	e
3	Reflotron	384	97.4	1.6	1.0	293	6.4	e
4	Fuji Dri-Chem	460	99.1	0.0	0.9	347	4.4	e
5	Spotchem/Ready	45	95.6	4.4	0.0	349	8.4	e
6	Spotchem D-Concept	120	98.4	0.8	0.8	347	5.4	e
7	Piccolo	16	100.0	0.0	0.0	364	3.8	e
8	Abx Mira	7	85.7	14.3	0.0	365	10.3	e*
9	Hitachi S40/M40	10	80.0	20.0	0.0	311	12.0	e*
10	Autolyser/DiaSys	14	100.0	0.0	0.0	371	3.1	e

LDL Cholesterin

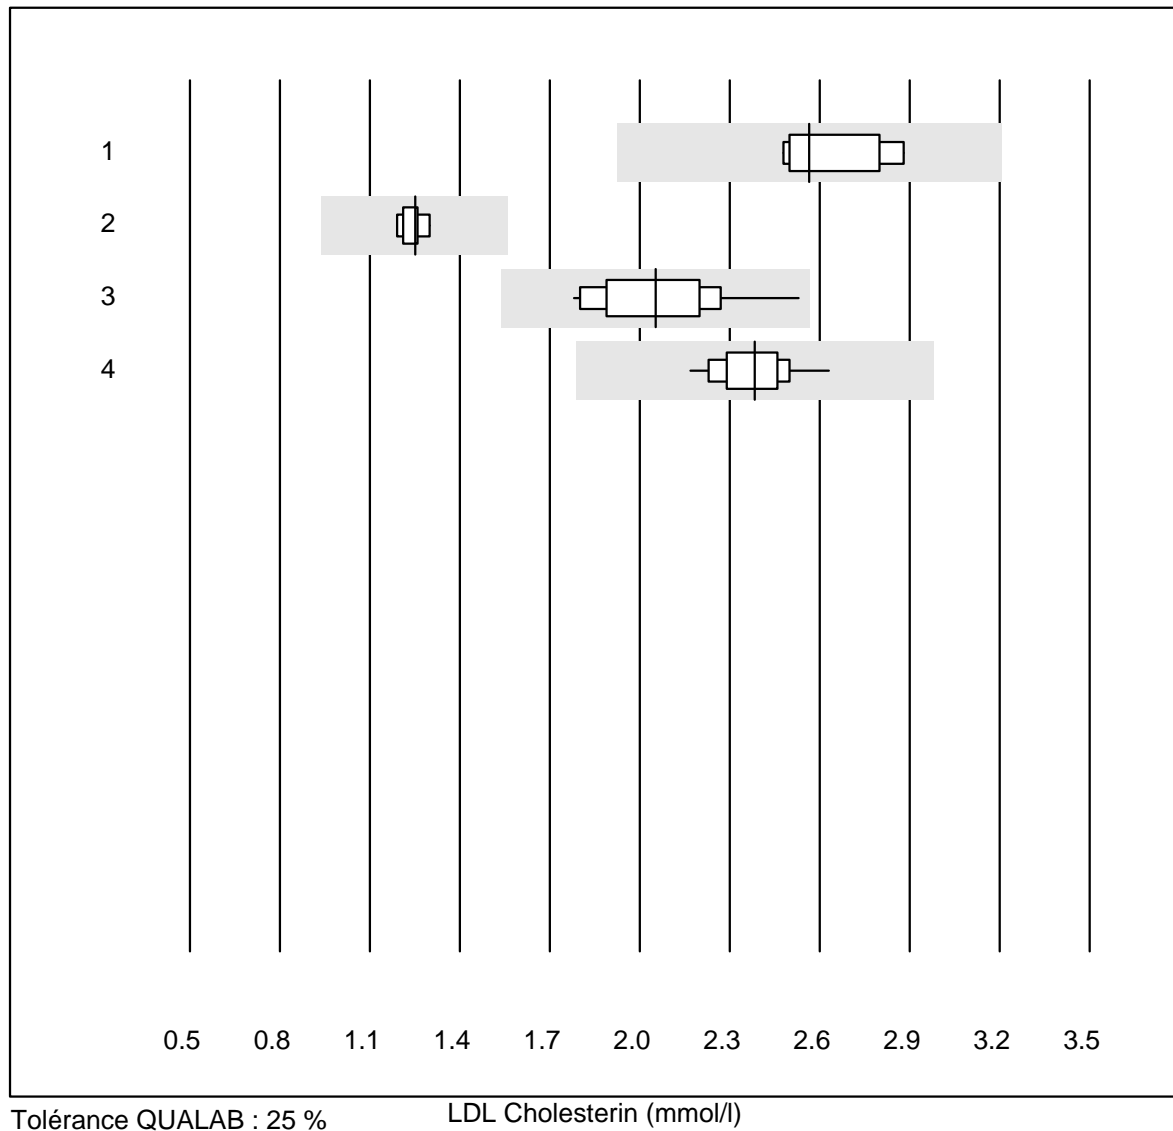


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Roche, Cobas	6	100.0	0.0	0.0	2.6	6.3	e
2 Hitachi S40/M40	8	100.0	0.0	0.0	1.3	3.0	e
3 Autolyser/DiaSys	14	100.0	0.0	0.0	2.1	10.3	e
4 Beckman	12	100.0	0.0	0.0	2.4	5.4	e

Fer

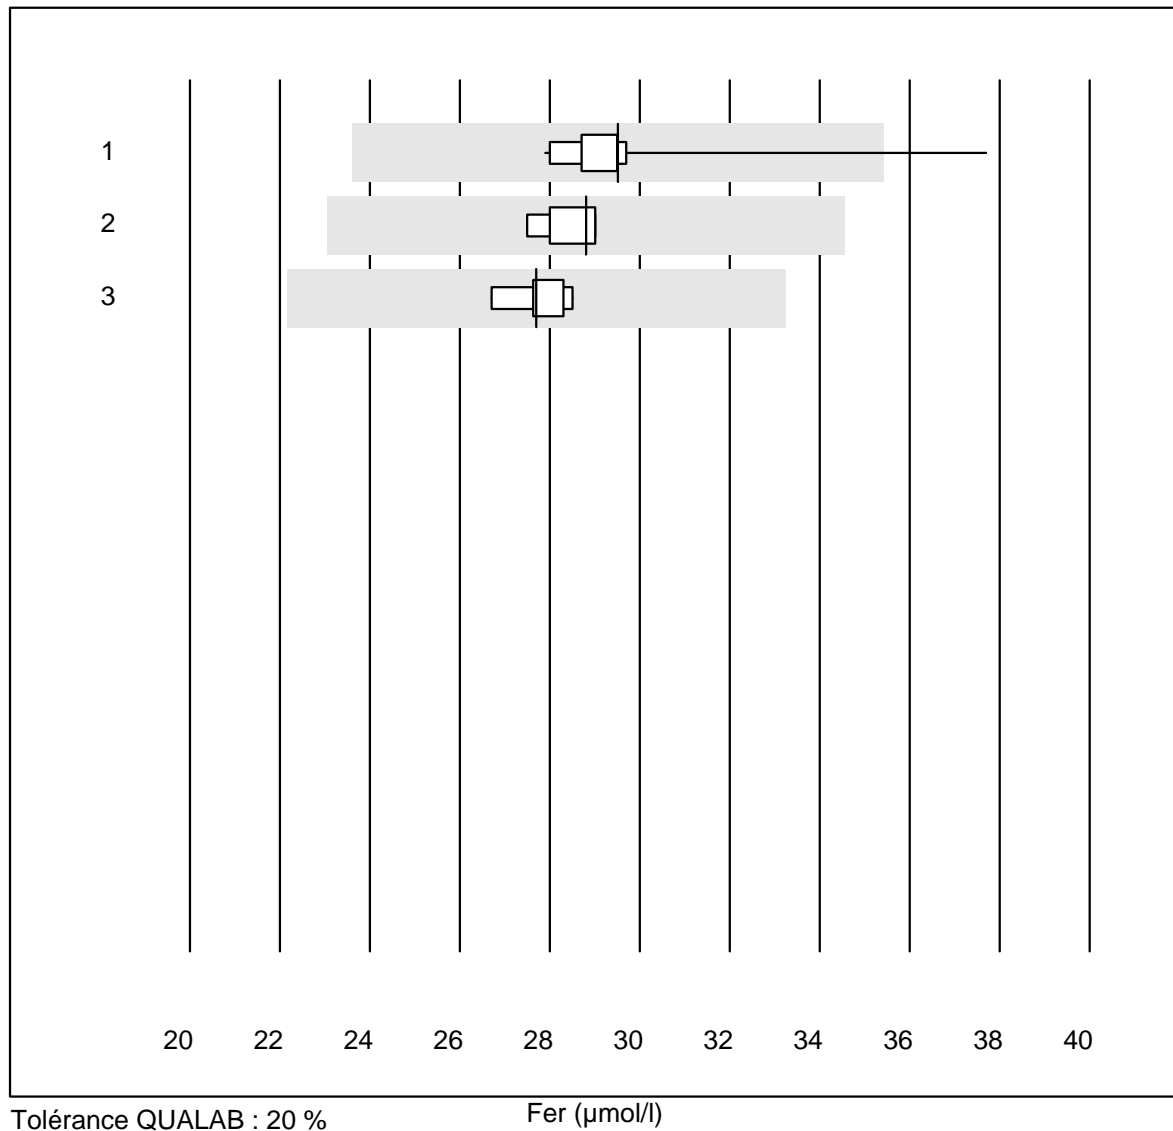

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	17	94.1	5.9	0.0	30	7.4	e
2	Cobas	9	100.0	0.0	0.0	29	2.0	e
3	Abx Mira	5	100.0	0.0	0.0	28	2.5	e

Gamma-GT

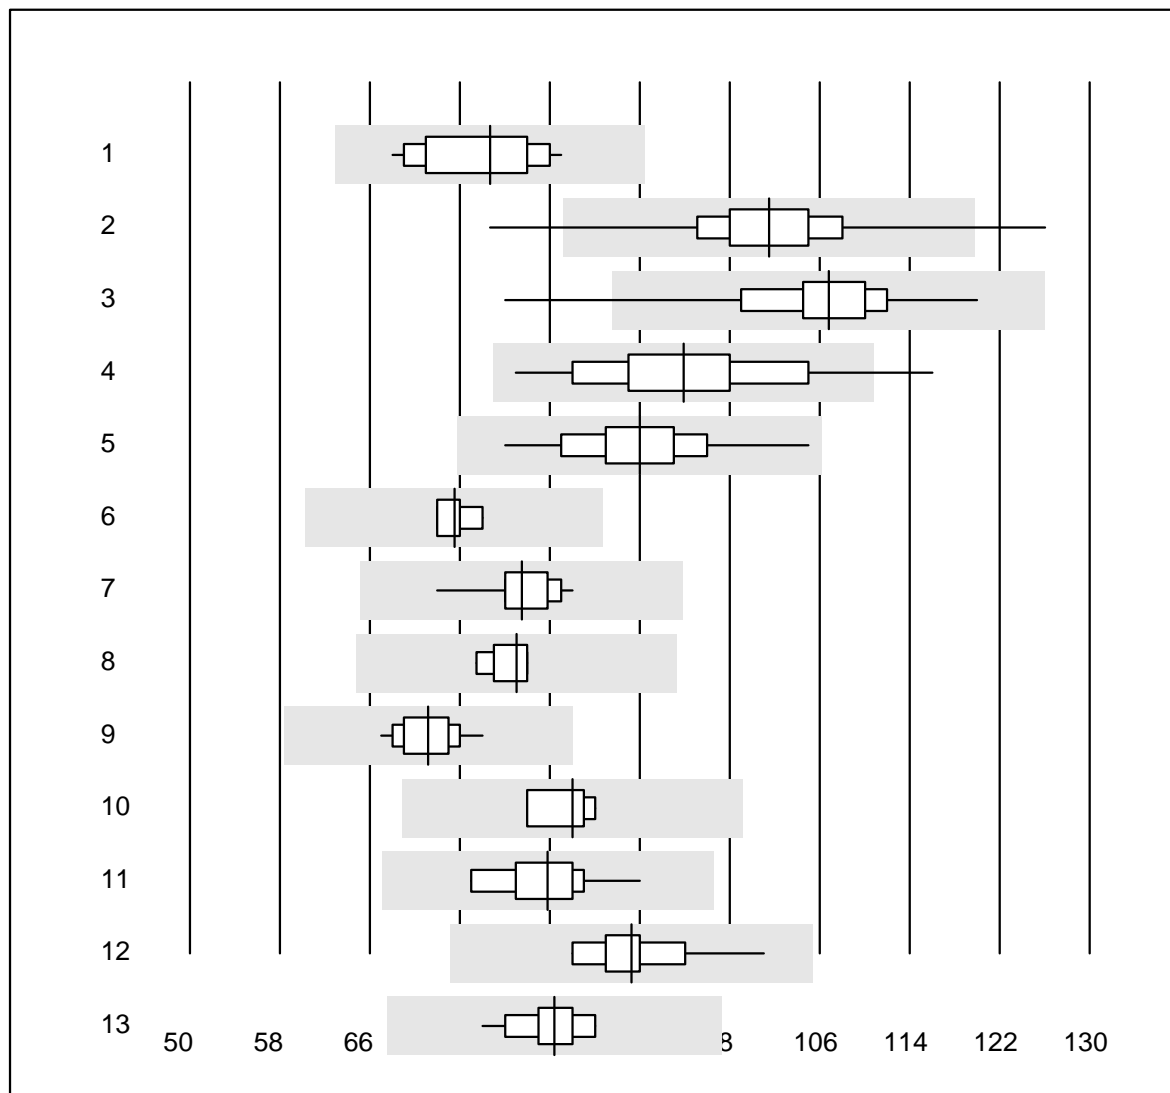


Tolérance QUALAB : 18 %

Gamma-GT (U/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas	18	100.0	0.0	0.0	77	6.5	e
2	Reflotron	792	98.3	0.9	0.8	102	5.6	e
3	Fuji Dri-Chem	793	99.6	0.4	0.0	107	5.1	e
4	Spotchem/Ready	120	97.5	1.7	0.8	94	8.2	e
5	Spotchem D-Concept	207	98.6	0.0	1.4	90	5.7	e
6	Architect	4	100.0	0.0	0.0	74	2.3	e
7	Dimension	13	100.0	0.0	0.0	80	3.9	e
8	IFCC Beckmann	8	100.0	0.0	0.0	79	2.1	e
9	Piccolo	31	100.0	0.0	0.0	71	3.5	e
10	Skyla	4	100.0	0.0	0.0	84	3.2	e
11	Abx Mira	10	100.0	0.0	0.0	82	5.4	e
12	Hitachi S40/M40	18	100.0	0.0	0.0	89	4.3	e
13	Autolyser/DiaSys	17	100.0	0.0	0.0	82	3.1	e

Glucose

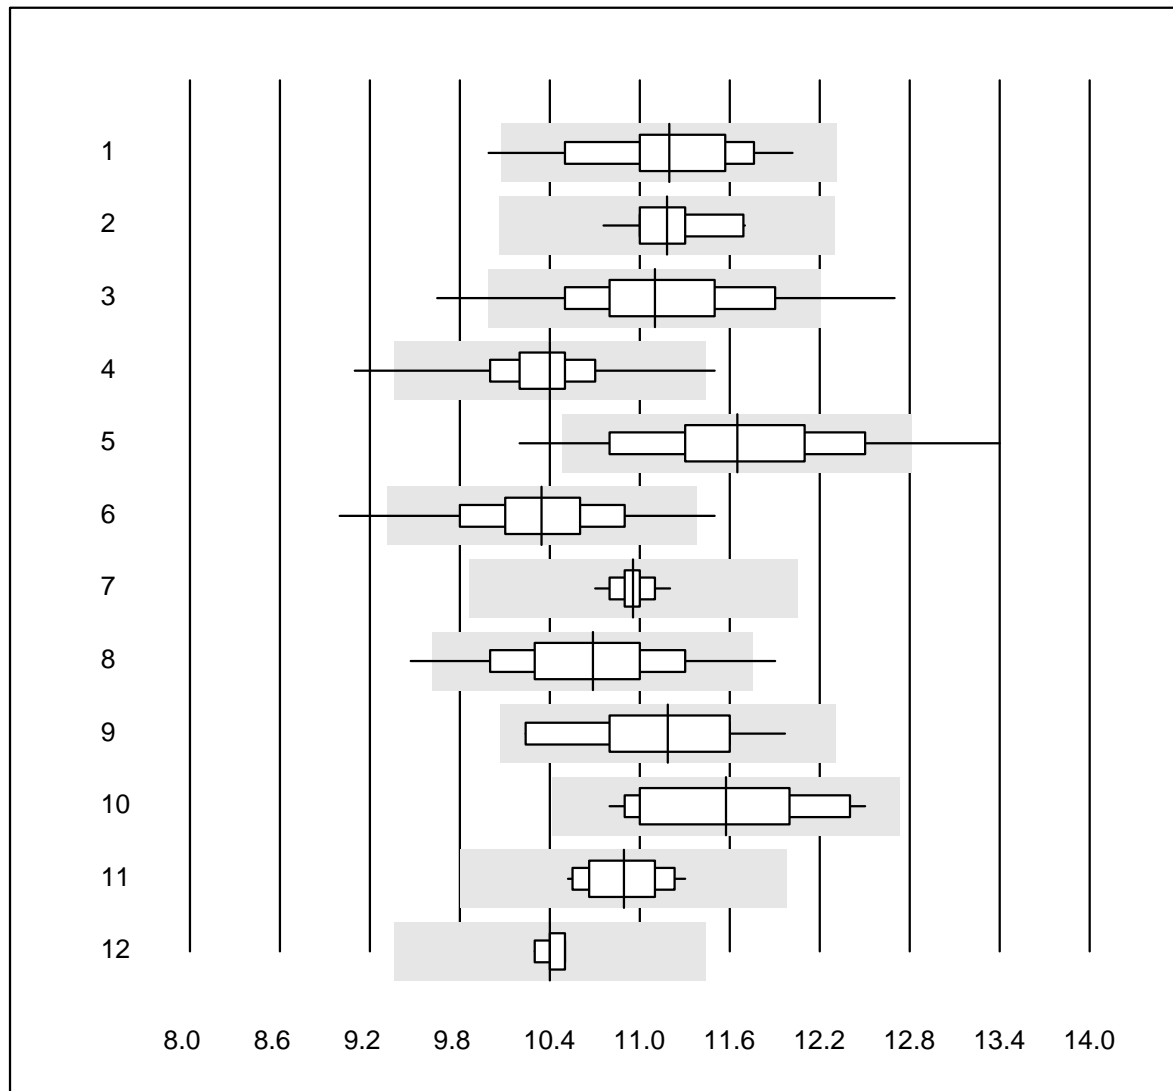


Tolérance QUALAB : 10 %

Glucose (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	36	97.2	2.8	0.0	11.2	4.4	e
2	Cobas	17	100.0	0.0	0.0	11.2	2.4	e
3	Reflotron	798	93.2	4.8	2.0	11.1	4.9	e
4	Fuji Dri-Chem	751	99.3	0.4	0.3	10.4	2.4	e
5	Spotchem/Ready	107	93.5	6.5	0.0	11.7	5.3	e
6	Spotchem D-Concept	194	97.9	2.1	0.0	10.3	4.0	e
7	Piccolo	43	100.0	0.0	0.0	11.0	1.2	e
8	Cholestech LDX	145	95.1	2.8	2.1	10.7	4.6	e
9	Abx Mira	10	100.0	0.0	0.0	11.2	4.5	e*
10	Hitachi S40/M40	19	100.0	0.0	0.0	11.6	4.6	e
11	Autolyser/DiaSys	17	100.0	0.0	0.0	10.9	2.3	e
12	iStat Chem8	7	85.7	0.0	14.3	10.4	0.7	e

Glucose

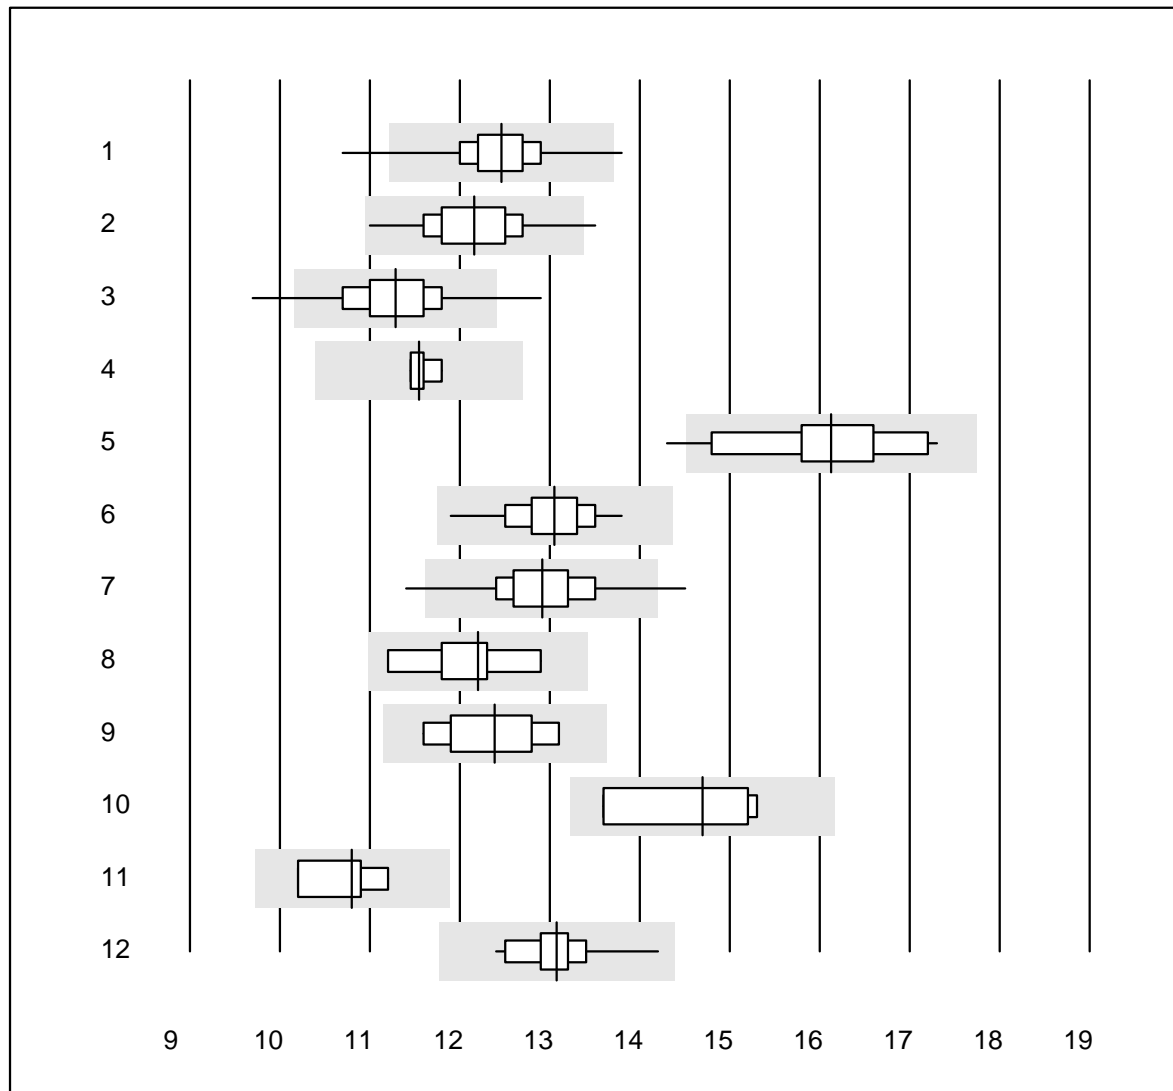


Tolérance QUALAB : 10 %

Glucose (mmol/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Accu-Chek Aviva	392	96.7	1.0	2.3	12.5	3.2	e
2	Accu-Chek Inform 2	378	98.9	0.3	0.8	12.2	3.5	e
3	Contour XT	1103	97.0	1.9	1.1	11.3	4.0	e
4	Skyla	4	100.0	0.0	0.0	11.6	1.3	e
5	Glucocard	17	94.1	5.9	0.0	16.1	5.0	e*
6	Hemocue 201+ P-equiv	89	98.9	0.0	1.1	13.1	2.9	e
7	Hemocue 201RT P-equiv	59	96.6	3.4	0.0	12.9	3.8	e
8	FreeStyle Precision	9	88.9	0.0	11.1	12.2	4.1	e*
9	Freestyle Freedom li	10	90.0	0.0	10.0	12.4	4.5	e*
10	Sanofi BG Star	4	100.0	0.0	0.0	14.7	5.6	e*
11	Contour NEXT ONE	4	100.0	0.0	0.0	10.8	3.9	e*
12	Accu-Check Guide	37	89.2	0.0	10.8	13.1	2.8	e

Glucose

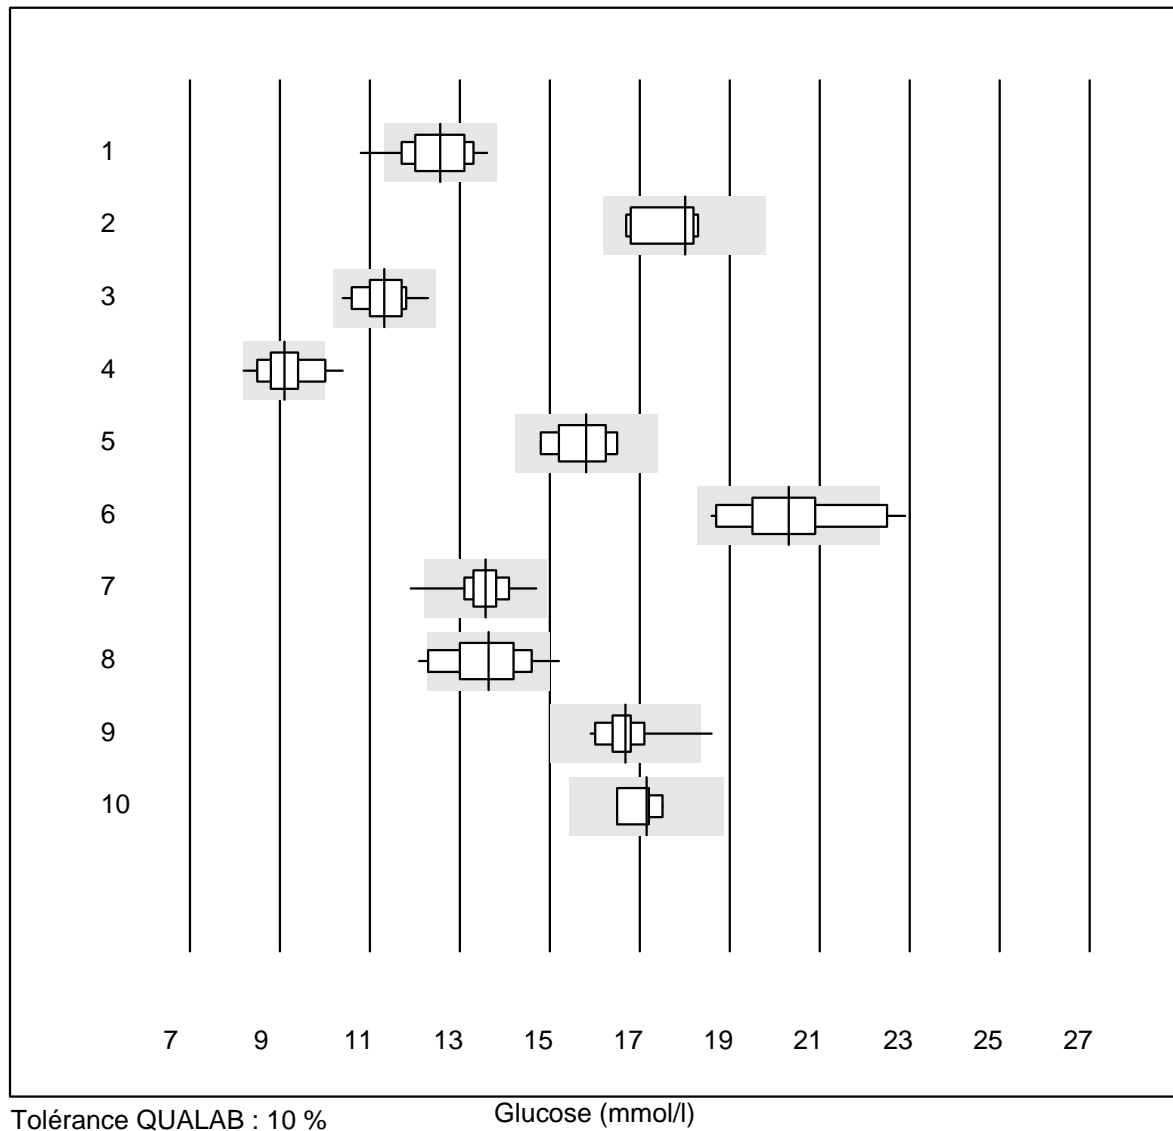

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Hemocue 201+ (alt)	47	97.9	2.1	0.0	12.6	5.1	e
2	OneTouch Ultra	5	100.0	0.0	0.0	18.0	4.5	e*
3	OneTouch Verio	26	100.0	0.0	0.0	11.3	4.3	e
4	Contour 2 (5s)	41	85.3	4.9	9.8	9.1	5.7	e
5	Contour (15s)	7	85.7	0.0	14.3	15.8	4.1	e*
6	Healthpro	19	84.2	10.5	5.3	20.3	6.3	e*
7	Mylife UNIO	190	99.5	0.5	0.0	13.6	3.1	e
8	mylife Pura	57	87.7	10.5	1.8	13.6	5.9	e
9	Omnitest	16	74.9	6.3	18.8	16.7	4.0	e
10	Alpha Check	4	100.0	0.0	0.0	17.2	2.5	e*

Acide urique

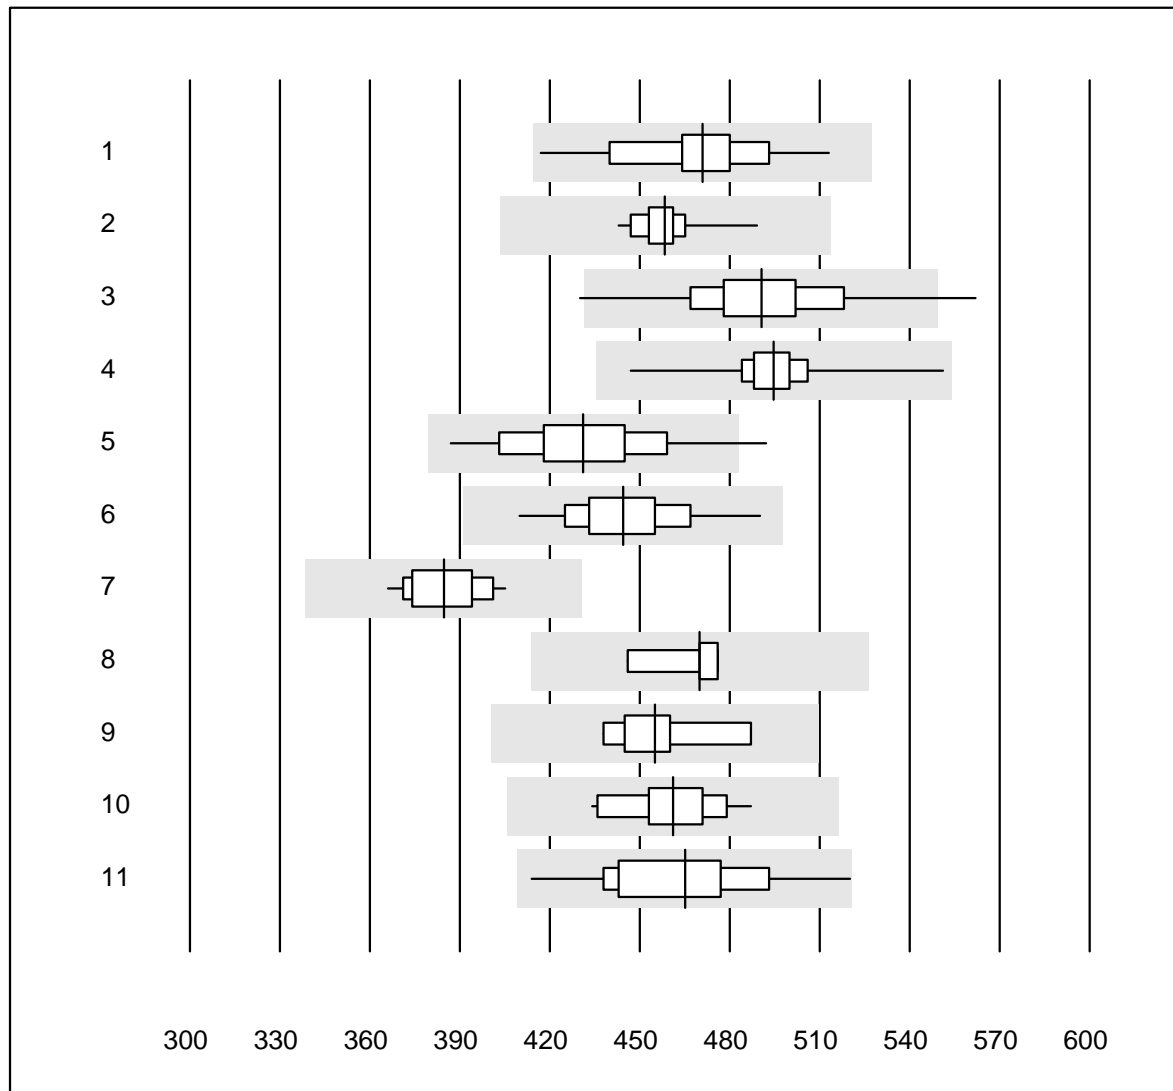


Tolérance QUALAB : 12 %

Acide urique (µmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	30	100.0	0.0	0.0	471	4.2	e
2	Cobas	14	100.0	0.0	0.0	458	2.3	e
3	Reflotron	694	98.7	0.3	1.0	491	4.0	e
4	Fuji Dri-Chem	753	99.2	0.0	0.8	495	2.0	e
5	Spotchem/Ready	99	99.0	1.0	0.0	431	5.0	e
6	Spotchem D-Concept	191	98.4	0.0	1.6	444	3.6	e
7	Piccolo	24	95.8	0.0	4.2	385	3.1	e
8	Skyla	5	100.0	0.0	0.0	470	2.7	e
9	Abx Mira	9	100.0	0.0	0.0	455	3.7	e
10	Hitachi S40/M40	17	100.0	0.0	0.0	461	3.1	e
11	Autolyser/DiaSys	15	100.0	0.0	0.0	465	5.6	e

Urée

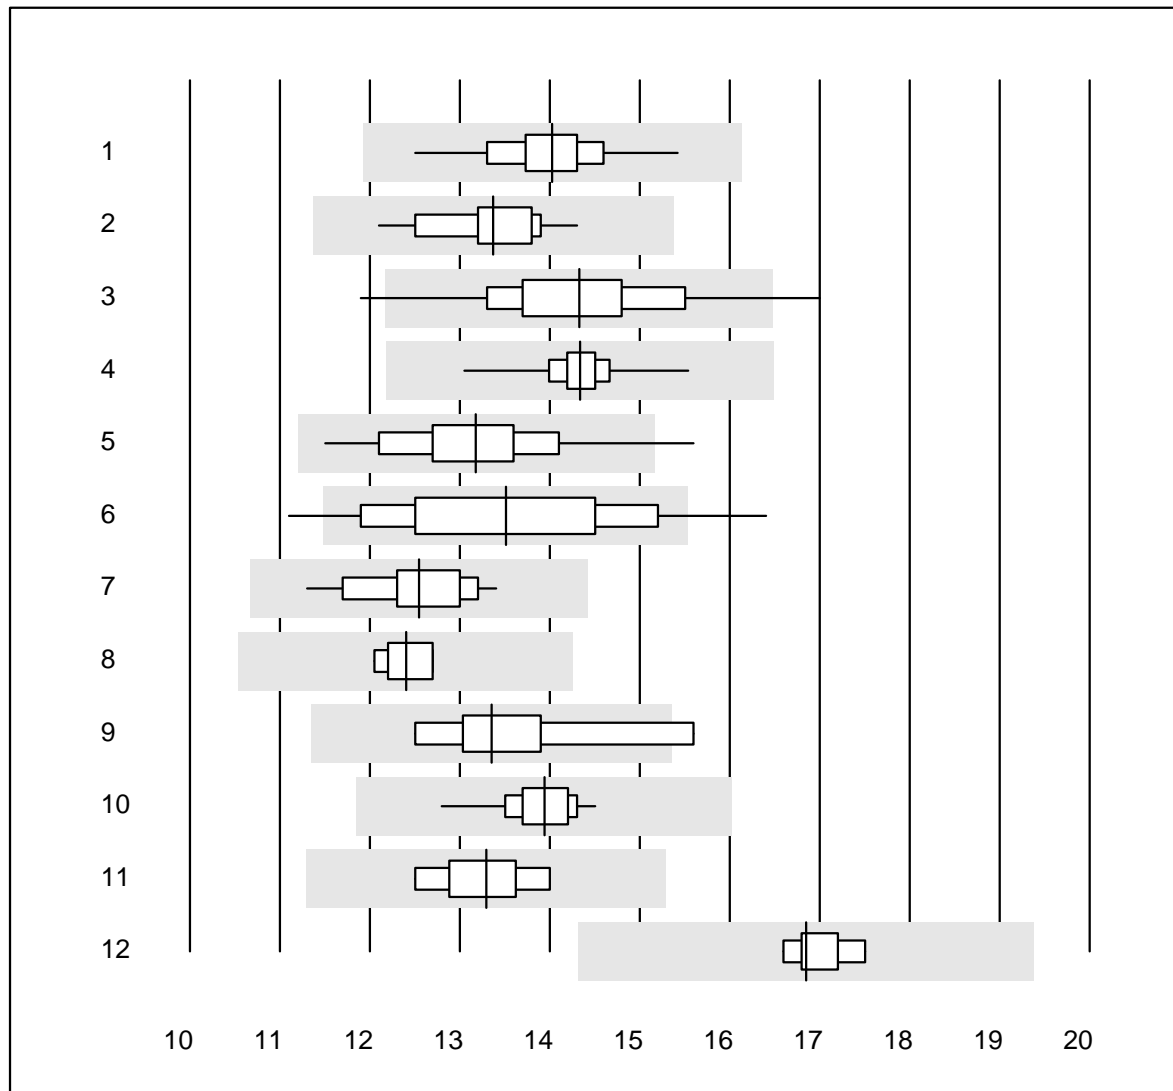


Tolérance QUALAB : 15 %

Urée (mmol/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	28	100.0	0.0	0.0	14.0	3.9	e
2	Cobas	16	100.0	0.0	0.0	13.4	4.1	e
3	Reflotron	312	96.8	2.2	1.0	14.3	6.3	e
4	Fuji Dri-Chem	452	100.0	0.0	0.0	14.3	2.0	e
5	Spotchem/Ready	60	98.3	1.7	0.0	13.2	6.3	e
6	Spotchem D-Concept	120	85.0	9.2	5.8	13.5	9.4	e
7	Piccolo	40	100.0	0.0	0.0	12.5	4.0	e
8	Skyla	5	100.0	0.0	0.0	12.4	2.4	e
9	Abx Mira	8	87.5	12.5	0.0	13.4	8.0	e*
10	Hitachi S40/M40	13	100.0	0.0	0.0	13.9	3.2	e
11	Autolyser/DiaSys	9	100.0	0.0	0.0	13.3	3.7	e
12	iStat Chem8	8	75.0	0.0	25.0	16.9	1.9	e

Potassium

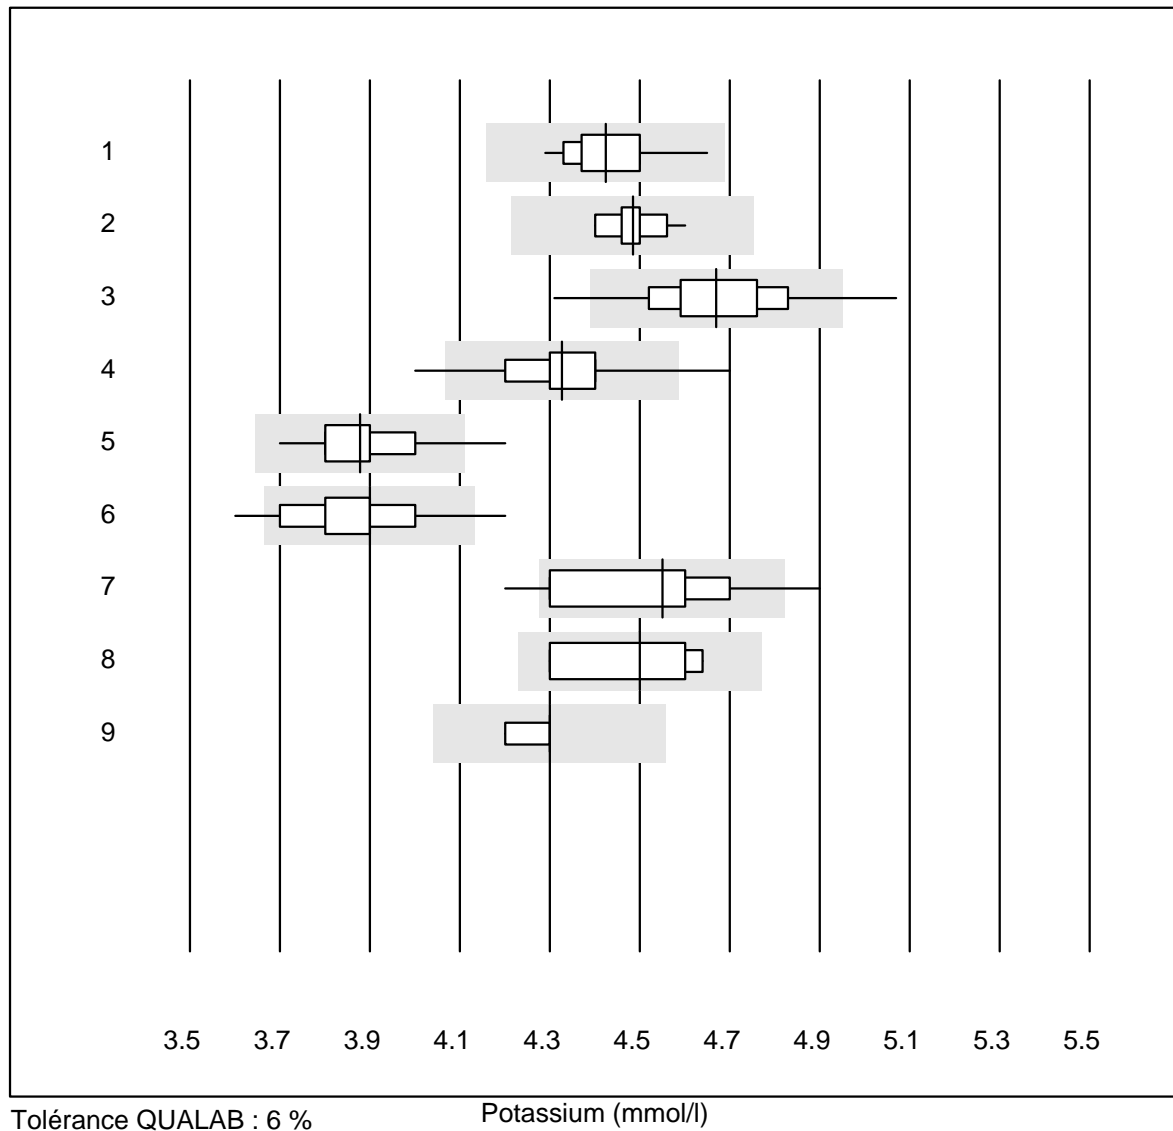


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	ISE	45	97.8	0.0	2.2	4.42	1.8	e
2	Cobas	17	100.0	0.0	0.0	4.48	1.2	e
3	Reflotron	715	94.9	2.0	3.1	4.67	2.6	e
4	Fuji Dri-Chem	791	97.2	1.0	1.8	4.33	1.9	e
5	Spotchem D-Concept	193	99.5	0.5	0.0	3.88	2.2	e
6	Spotchem EL-SE 1520	109	90.8	4.6	4.6	3.90	3.0	e
7	Piccolo	28	85.7	10.7	3.6	4.55	4.0	e*
8	Abx Mira	4	100.0	0.0	0.0	4.50	3.6	e*
9	iStat Chem8	9	88.9	0.0	11.1	4.30	0.8	e

Créatinine

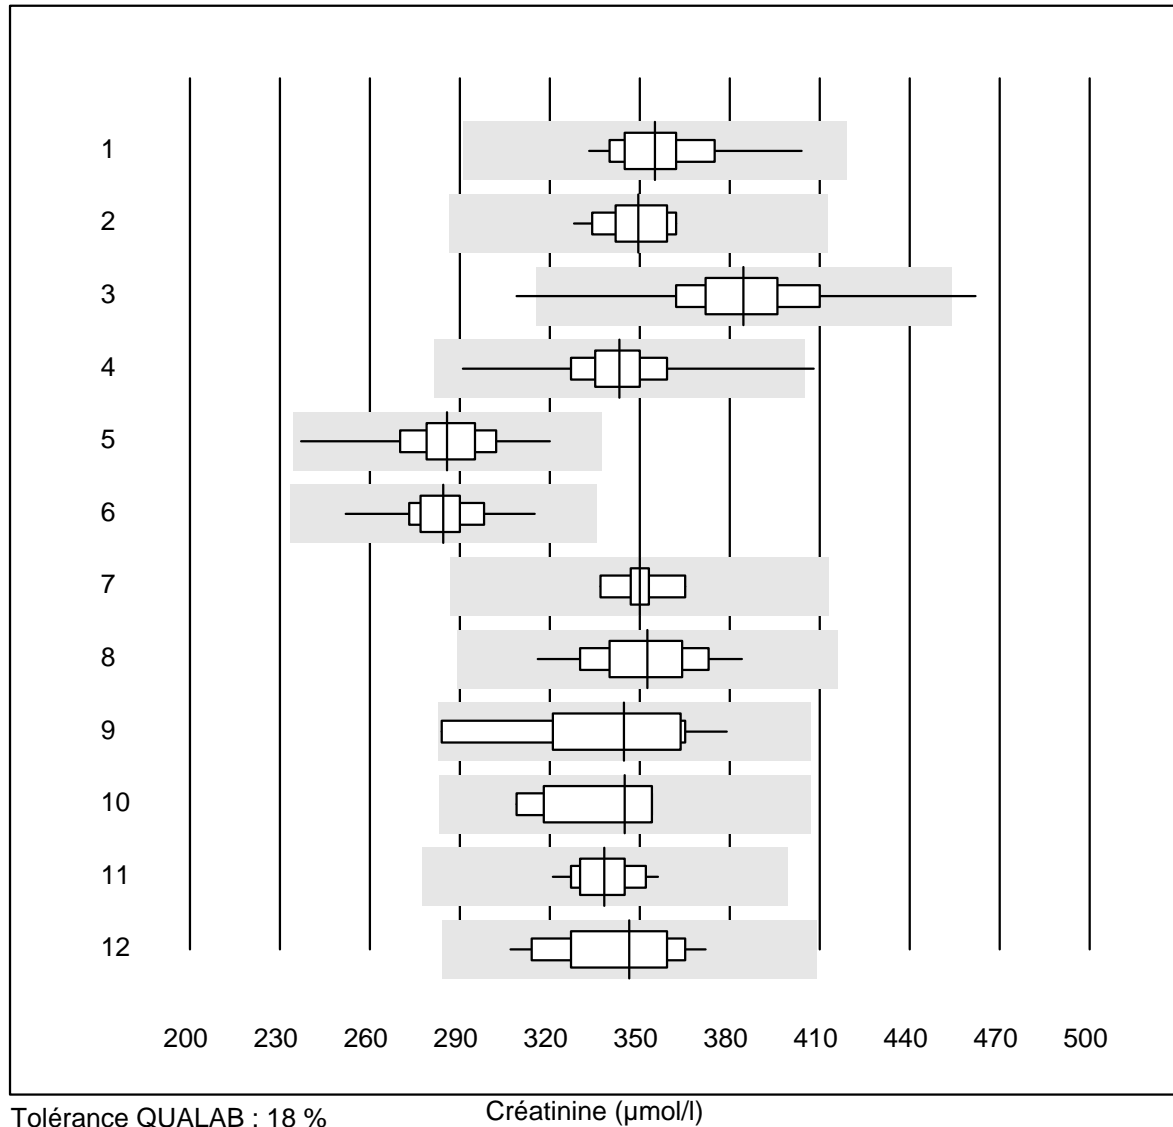

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	24	95.8	0.0	4.2	355	4.4	e
2	Cobas	18	100.0	0.0	0.0	349	3.0	e
3	Reflotron	907	98.3	0.7	1.0	385	5.1	e
4	Fuji Dri-Chem	817	99.3	0.1	0.6	343	3.9	e
5	Spotchem/Ready	126	99.2	0.0	0.8	286	4.8	e
6	Spotchem D-Concept	201	99.5	0.0	0.5	284	3.5	e
7	Enzymatisch	9	100.0	0.0	0.0	350	2.2	e
8	Piccolo	42	100.0	0.0	0.0	353	4.8	e
9	Abx Mira	10	100.0	0.0	0.0	345	8.5	e*
10	Skyla	6	100.0	0.0	0.0	345	5.7	e*
11	Hitachi S40/M40	18	100.0	0.0	0.0	338	2.9	e
12	Autolyser/DiaSys	17	100.0	0.0	0.0	347	5.7	e

Créatinine E

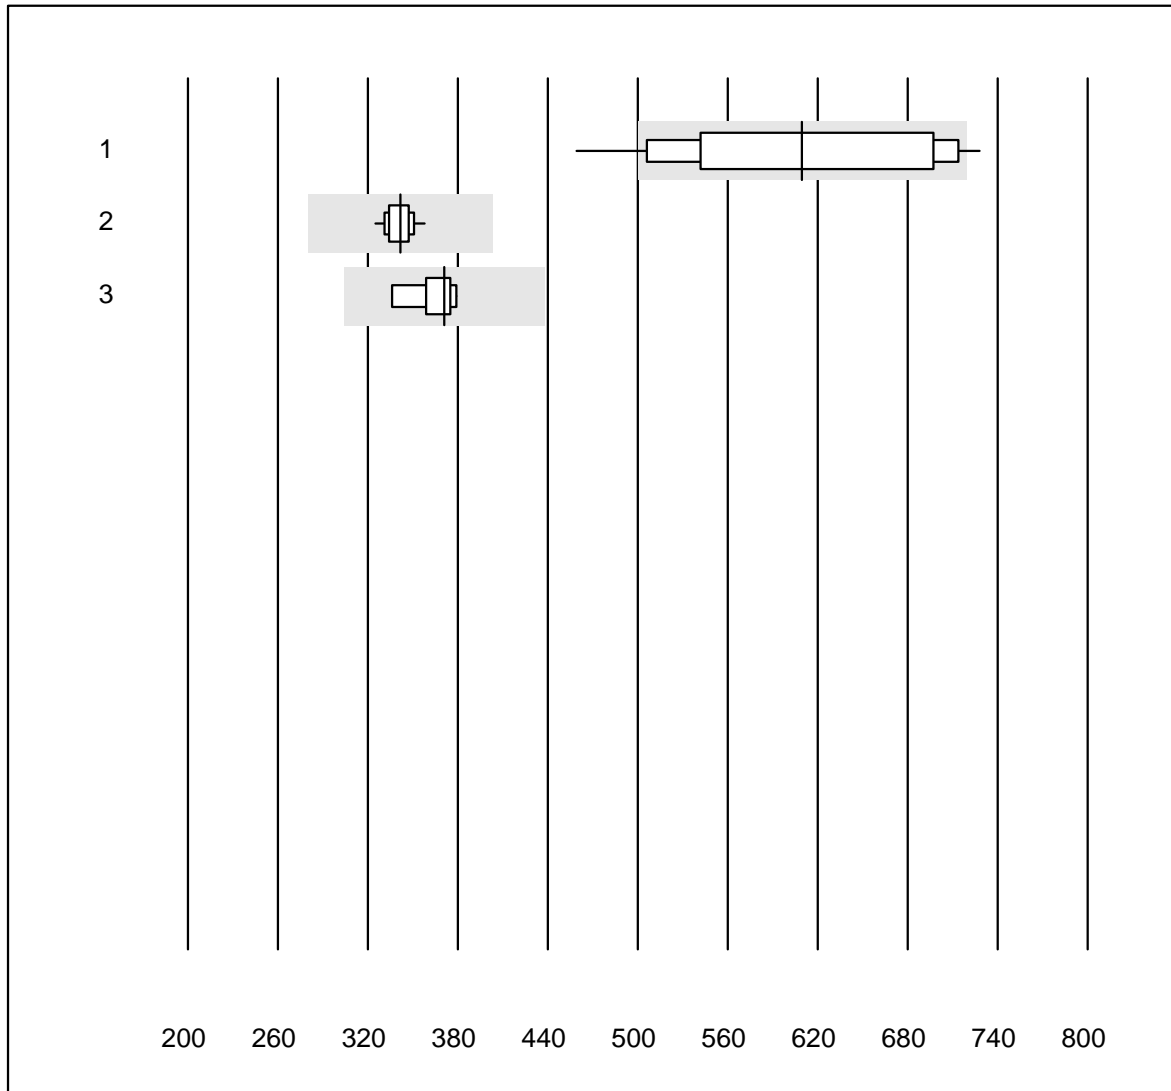


Tolérance QUALAB : 18 %

Créatinine E (µmol/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Statsensor i / Nova	42	83.4	9.5	7.1	610	13.5	e
2 iStat Chem8	14	85.7	0.0	14.3	342	2.7	e
3 ABL700/800	9	100.0	0.0	0.0	371	3.8	e

eGFR CKD-EPI

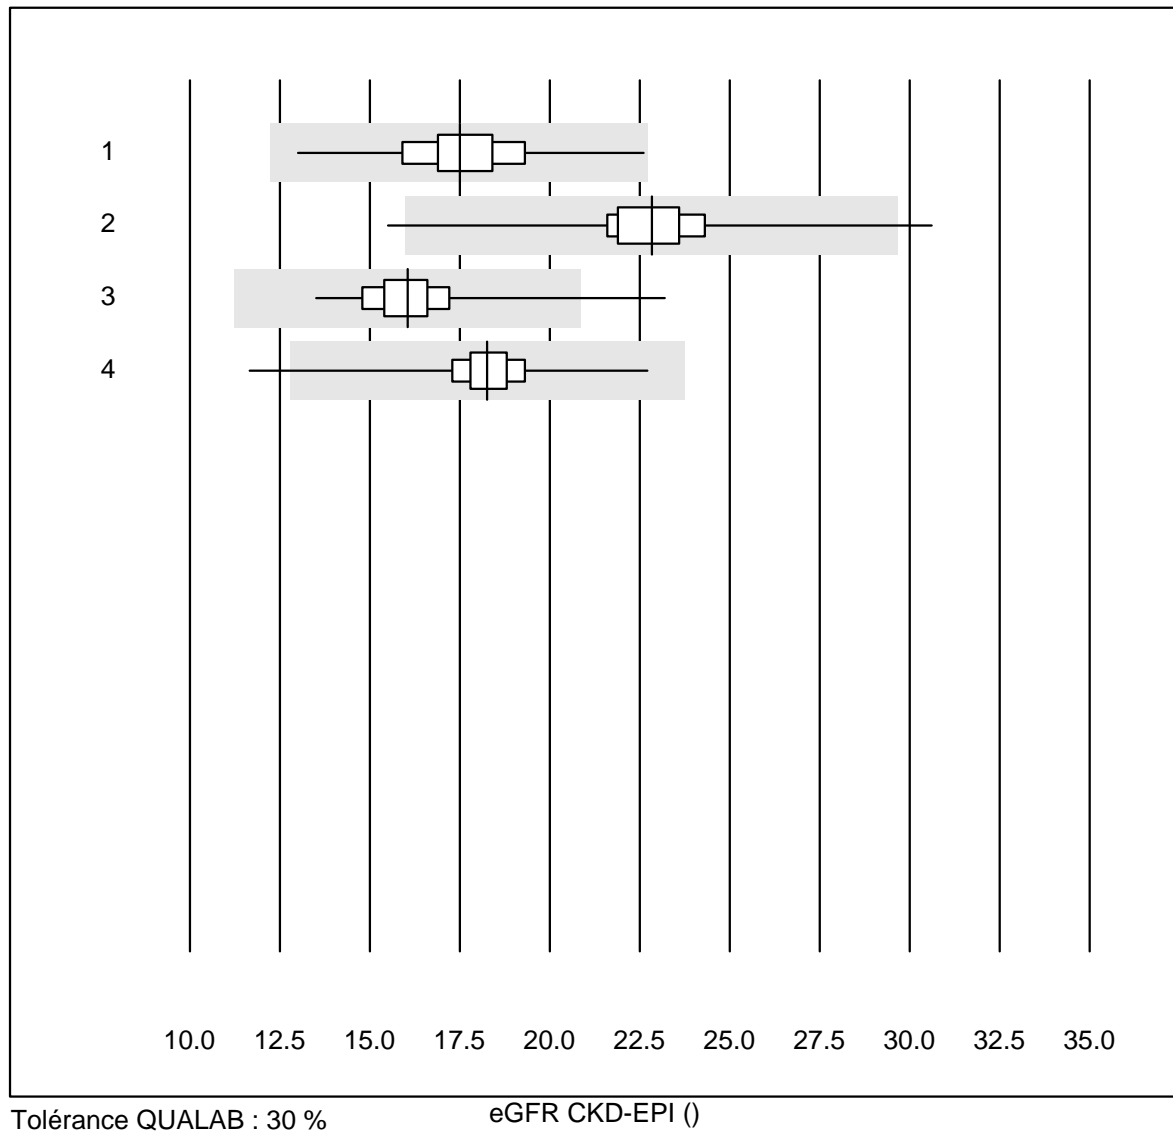


Tolérance QUALAB : 30 %

eGFR CKD-EPI ()

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	61	96.7	0.0	3.3	17	9.6	e
2	Spotchem/Ready	127	90.5	1.6	7.9	23	7.5	e
3	Reflotron	314	96.5	0.6	2.9	16	6.7	e
4	Fuji Dri-Chem	331	94.9	0.3	4.8	18	5.4	e

eGFR Cockcroft-Gault

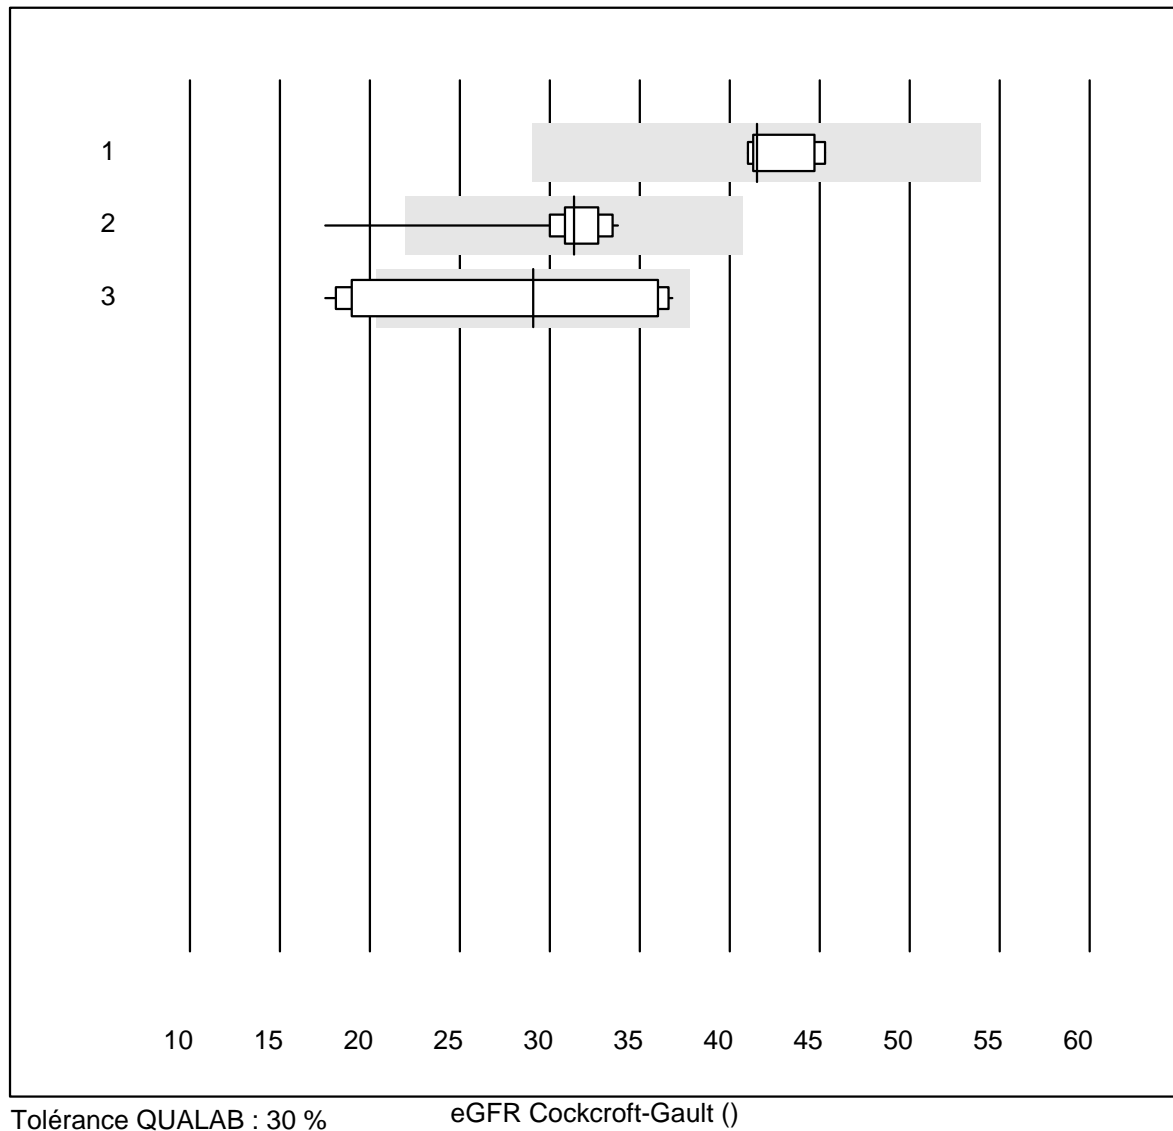


Tolérance QUALAB : 30 %

eGFR Cockcroft-Gault ()


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Spotchem/Ready	7	85.7	0.0	14.3	42	4.3	e
2 Reflotron	31	74.2	3.2	22.6	31	10.1	e
3 Fuji Dri-Chem	25	64.0	32.0	4.0	29	28.4	e*

eGFR MDRD

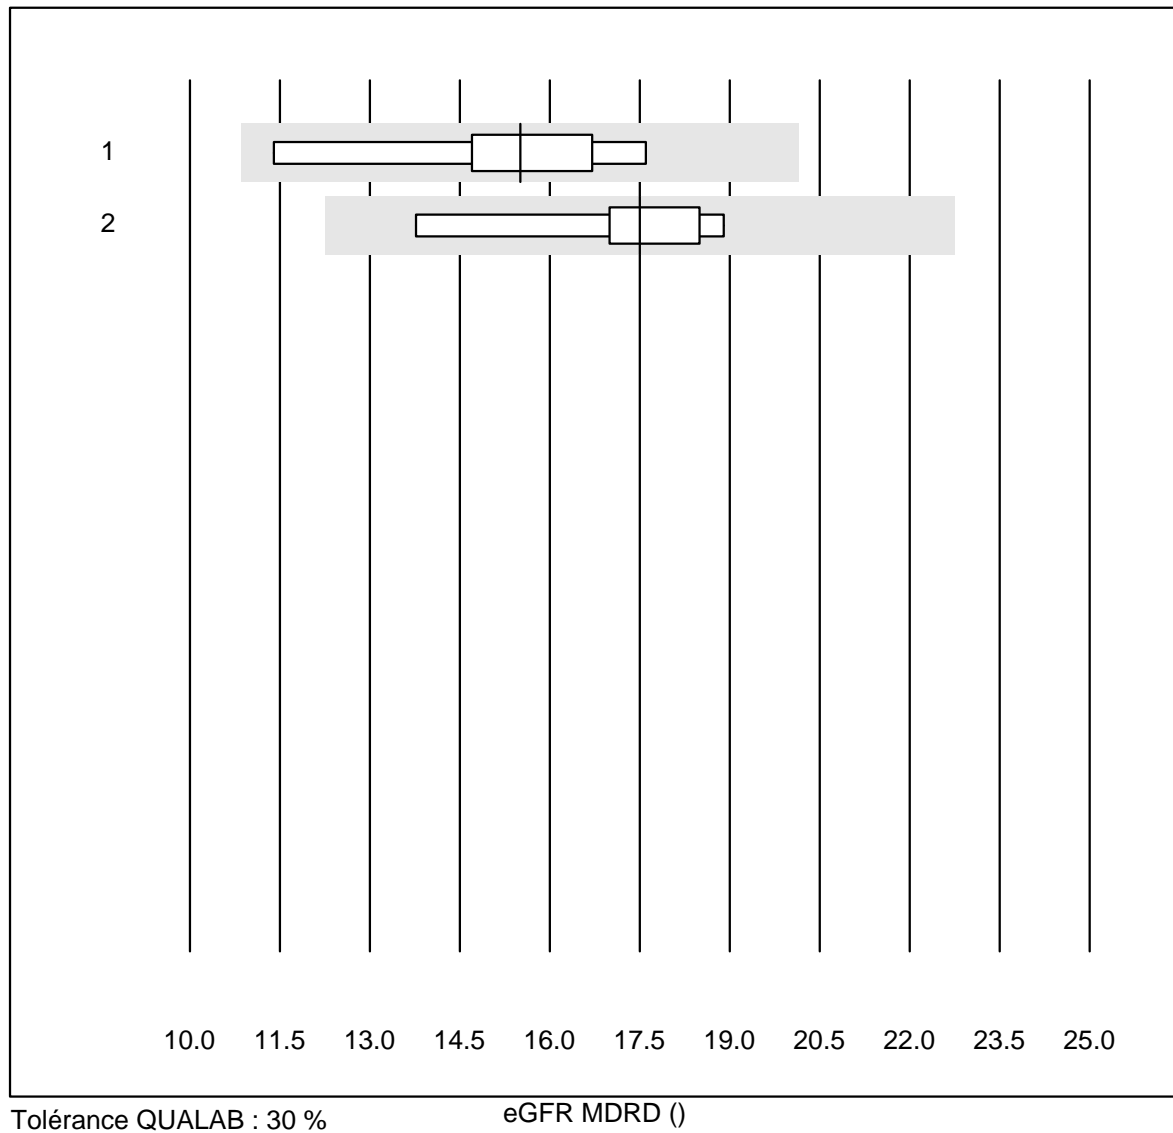

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Reflotron	10	90.0	0.0	10.0	16	11.9	e*
2 Fuji Dri-Chem	5	100.0	0.0	0.0	18	11.8	e*

LDH

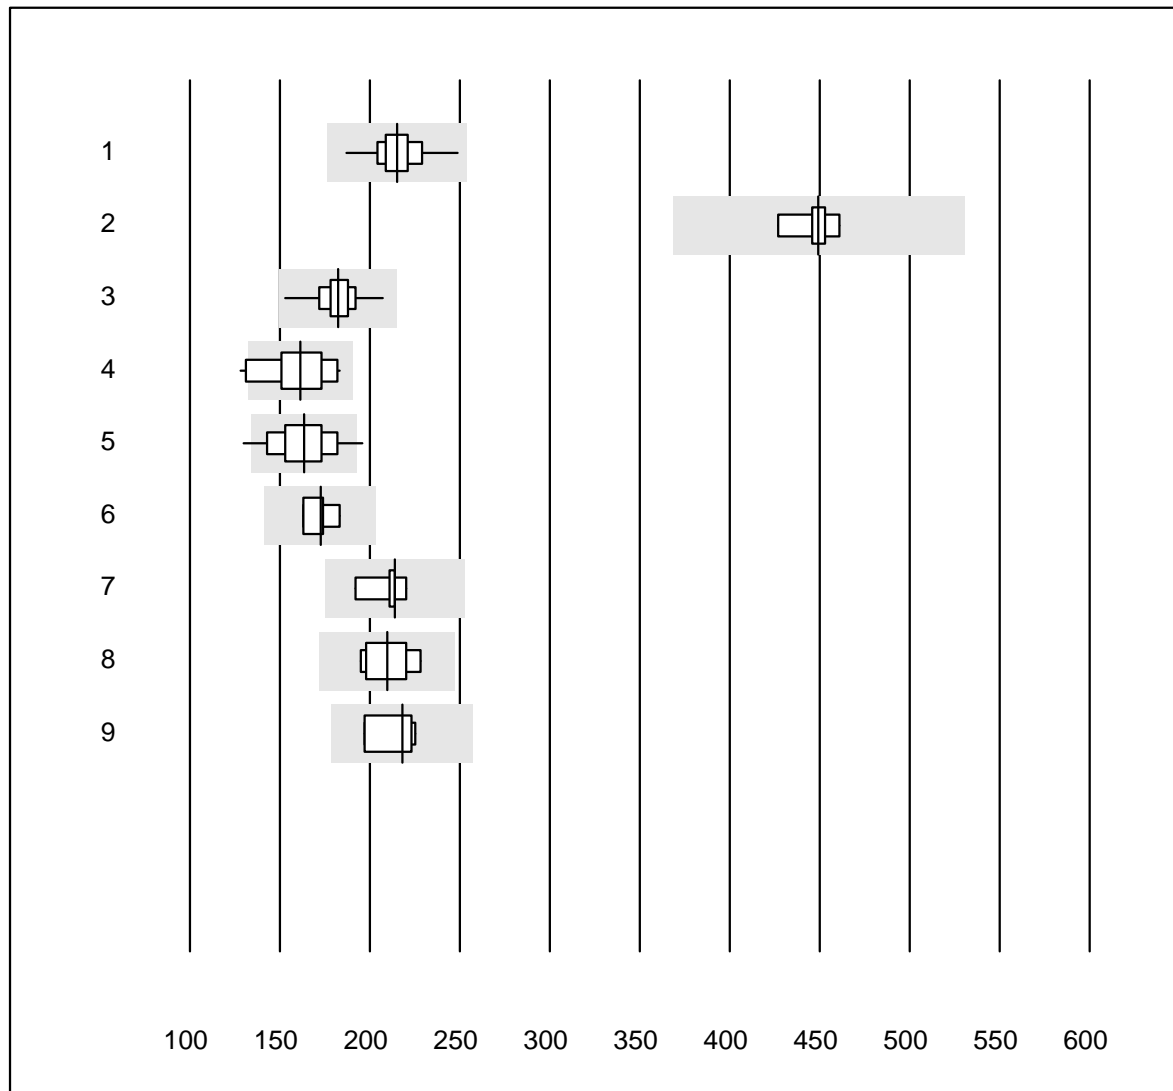


Tolérance QUALAB : 18 %

LDH (U/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	IFCC	32	100.0	0.0	0.0	215	5.8	e
2	Cobas	9	100.0	0.0	0.0	449	2.2	e
3	Fuji Dri-Chem	148	99.3	0.0	0.7	182	4.5	e
4	Spotchem/Ready	17	82.3	11.8	5.9	161	10.1	e*
5	Spotchem D-Concept	43	88.4	9.3	2.3	163	9.5	e
6	Piccolo	4	100.0	0.0	0.0	173	4.8	e*
7	Abx Mira	7	85.7	0.0	14.3	214	4.6	e
8	Hitachi S40/M40	6	100.0	0.0	0.0	210	6.0	e*
9	Autolyser/DiaSys	8	100.0	0.0	0.0	218	5.5	e

Magnésium

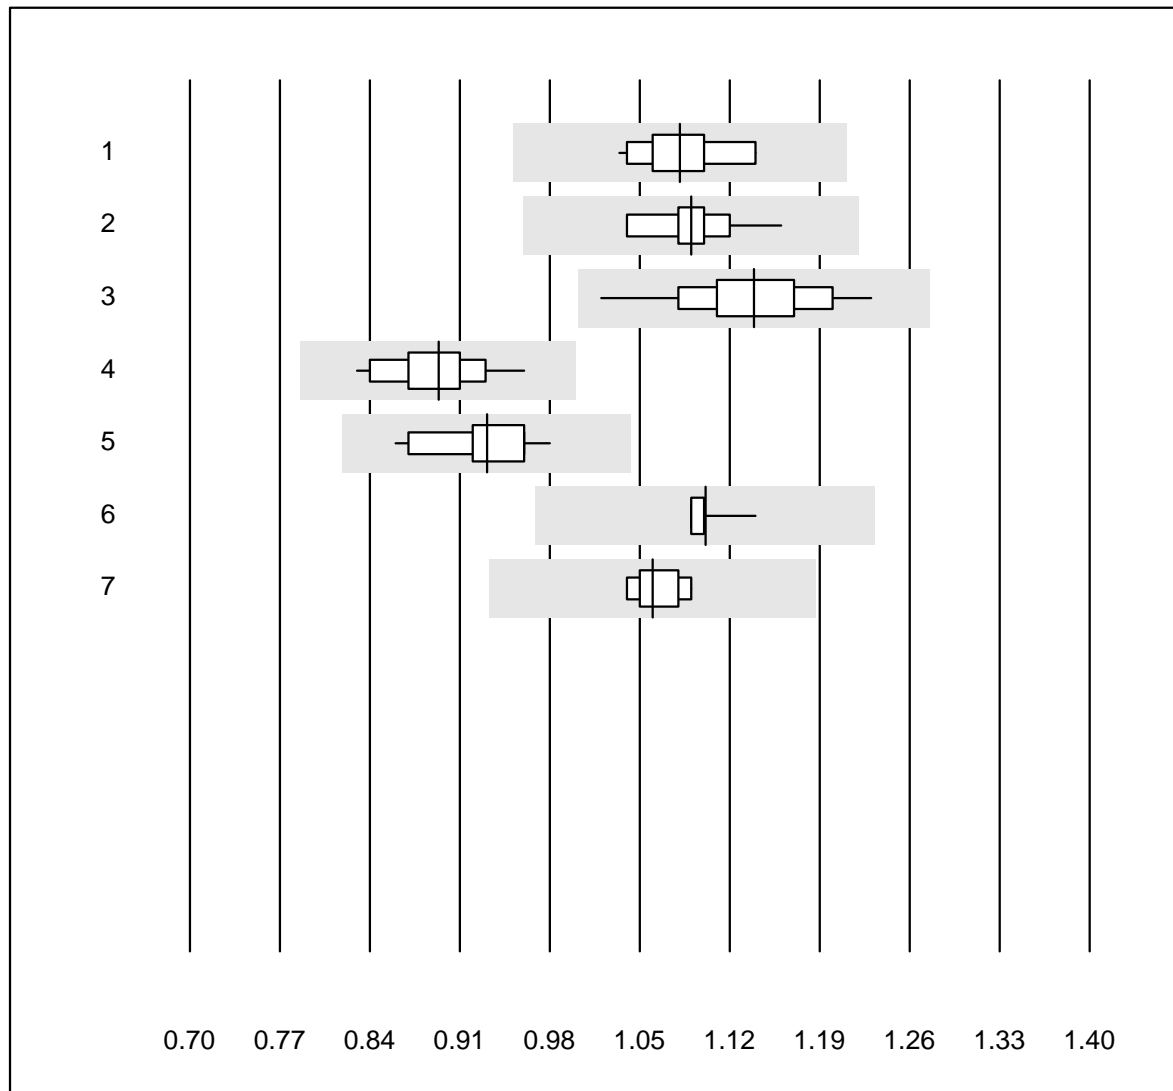


Tolérance QUALAB : 12 %

Magnésium (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	14	100.0	0.0	0.0	1.08	2.9	e
2	Cobas	10	100.0	0.0	0.0	1.09	3.2	e
3	Fuji Dri-Chem	119	99.2	0.0	0.8	1.14	4.1	e
4	Spotchem D-Concept	40	100.0	0.0	0.0	0.89	3.8	e
5	Spotchem/Ready	12	91.7	0.0	8.3	0.93	3.9	e
6	Beckman	10	100.0	0.0	0.0	1.10	1.3	e
7	Piccolo	7	100.0	0.0	0.0	1.06	1.6	e

Sodium

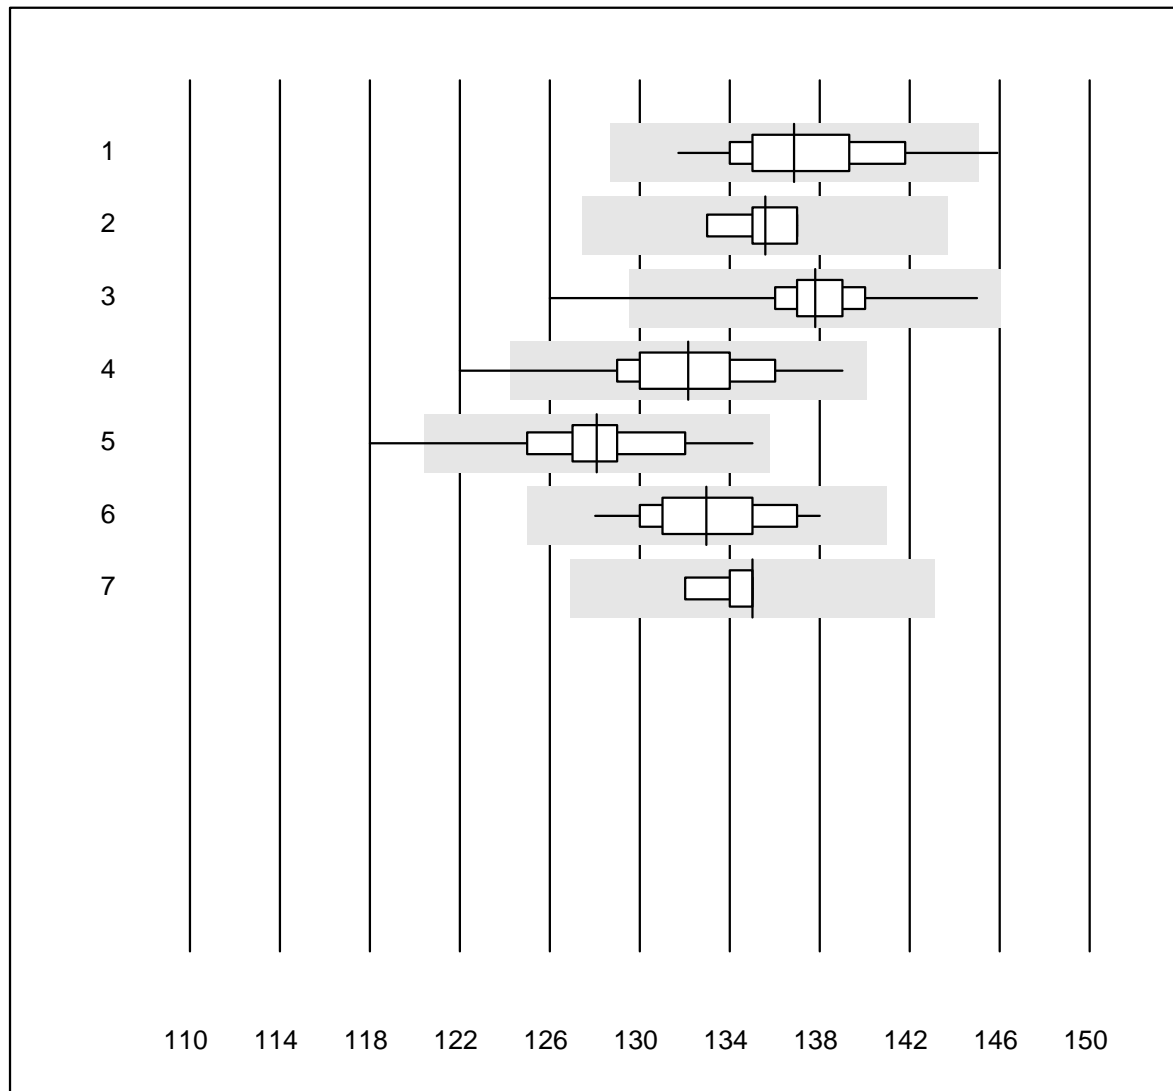


Tolérance QUALAB : 6 %

Sodium (mmol/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ISE	43	95.3	4.7	0.0	137	2.4	e
2 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	136	1.0	e
3 Fuji Dri-Chem	734	98.0	1.2	0.8	138	1.5	e
4 Spotchem D-Concept	185	97.3	1.1	1.6	132	2.1	e
5 Spotchem EL-SE 1520	109	98.2	0.9	0.9	128	2.2	e
6 Piccolo	29	100.0	0.0	0.0	133	1.9	e
7 iStat Chem8	8	100.0	0.0	0.0	135	0.8	e

Phosphates

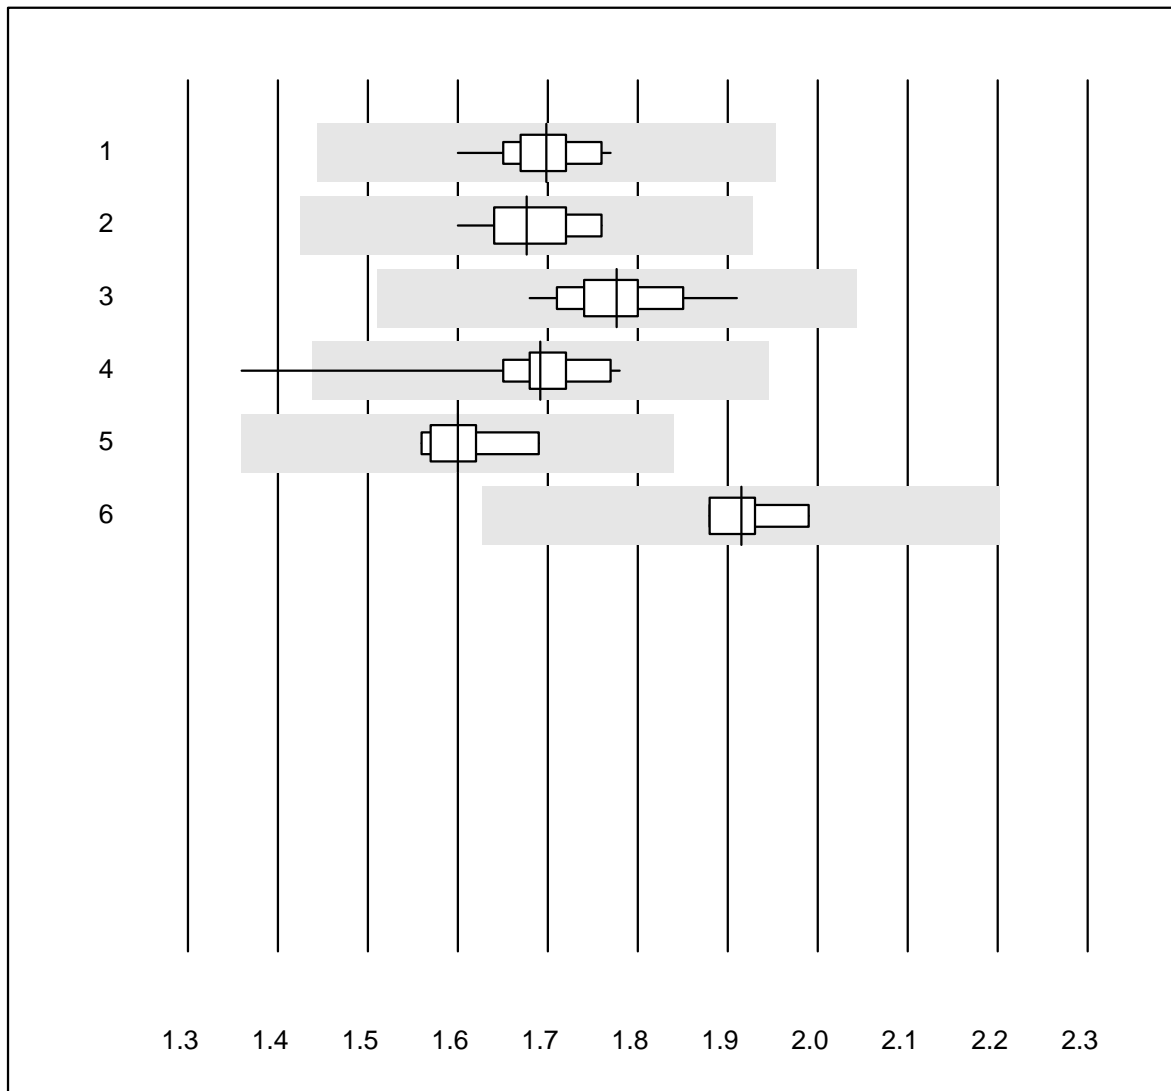


Tolérance QUALAB : 15 %

Phosphates (mmol/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	23	100.0	0.0	0.0	1.7	2.6	e
2	Cobas	11	100.0	0.0	0.0	1.7	3.1	e
3	Fuji Dri-Chem	83	98.8	0.0	1.2	1.8	3.0	e
4	Spotchem D-Concept	20	95.0	5.0	0.0	1.7	5.1	e
5	Spotchem/Ready	8	100.0	0.0	0.0	1.6	2.7	e
6	Piccolo	4	100.0	0.0	0.0	1.9	2.5	e

Protéine

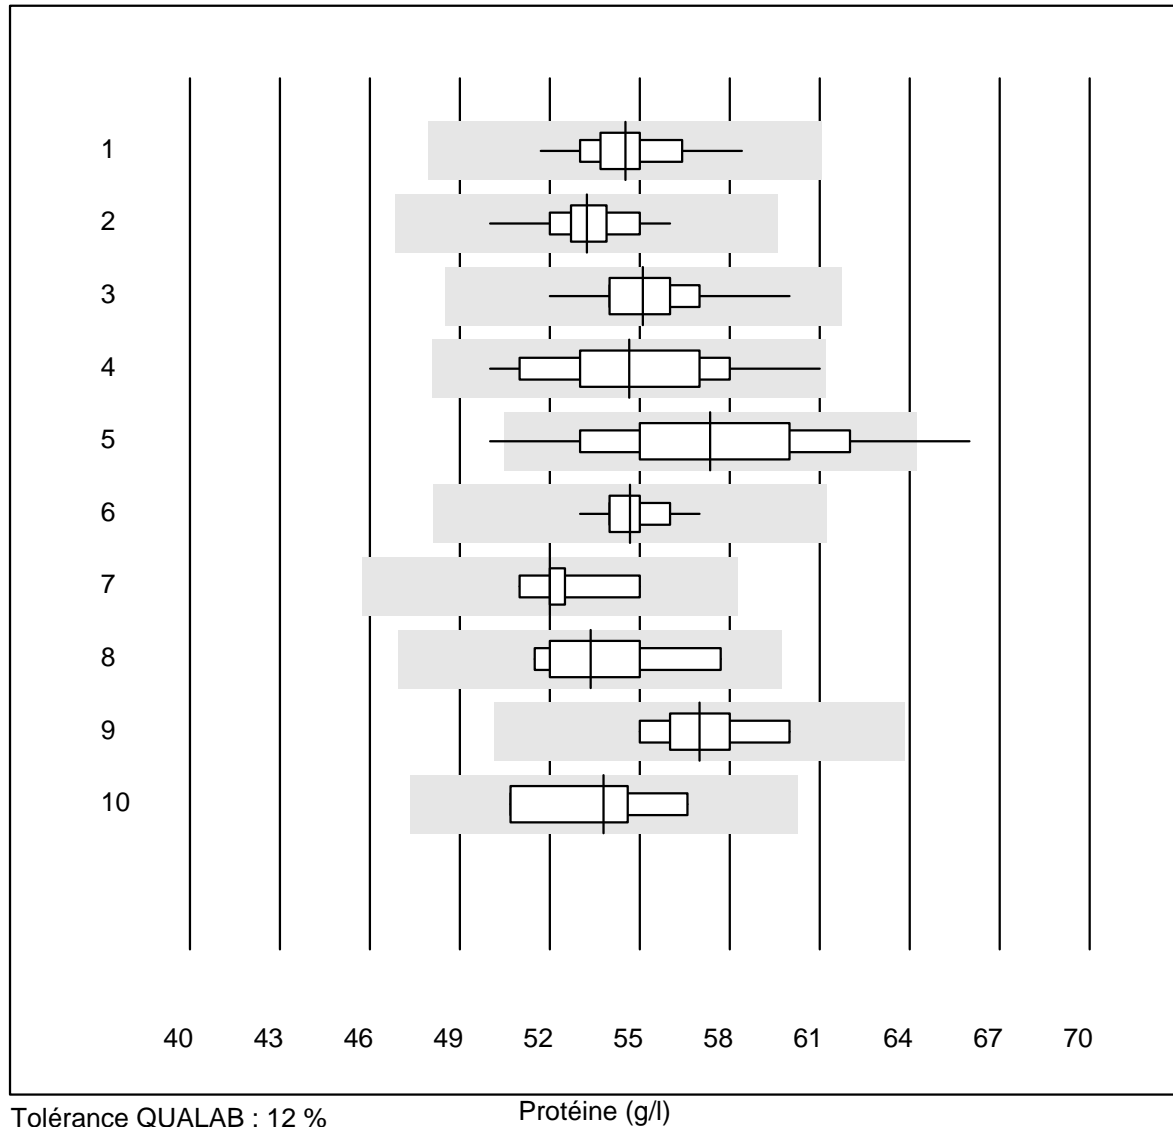

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	28	100.0	0.0	0.0	54.5	2.5	e
2	Cobas	12	100.0	0.0	0.0	53.2	2.8	e
3	Fuji Dri-Chem	180	98.9	0.0	1.1	55.1	2.3	e
4	Spotchem/Ready	30	96.7	0.0	3.3	54.7	5.0	e
5	Spotchem D-Concept	82	95.1	4.9	0.0	57.3	6.3	e
6	Piccolo	27	100.0	0.0	0.0	54.7	1.8	e
7	Skyla	5	100.0	0.0	0.0	52.0	2.9	e
8	Abx Mira	6	100.0	0.0	0.0	53.4	4.2	e*
9	Hitachi S40/M40	7	100.0	0.0	0.0	57.0	2.9	e
10	Autolyser/DiaSys	4	100.0	0.0	0.0	53.8	4.6	e*

Transaminase GOT/AST

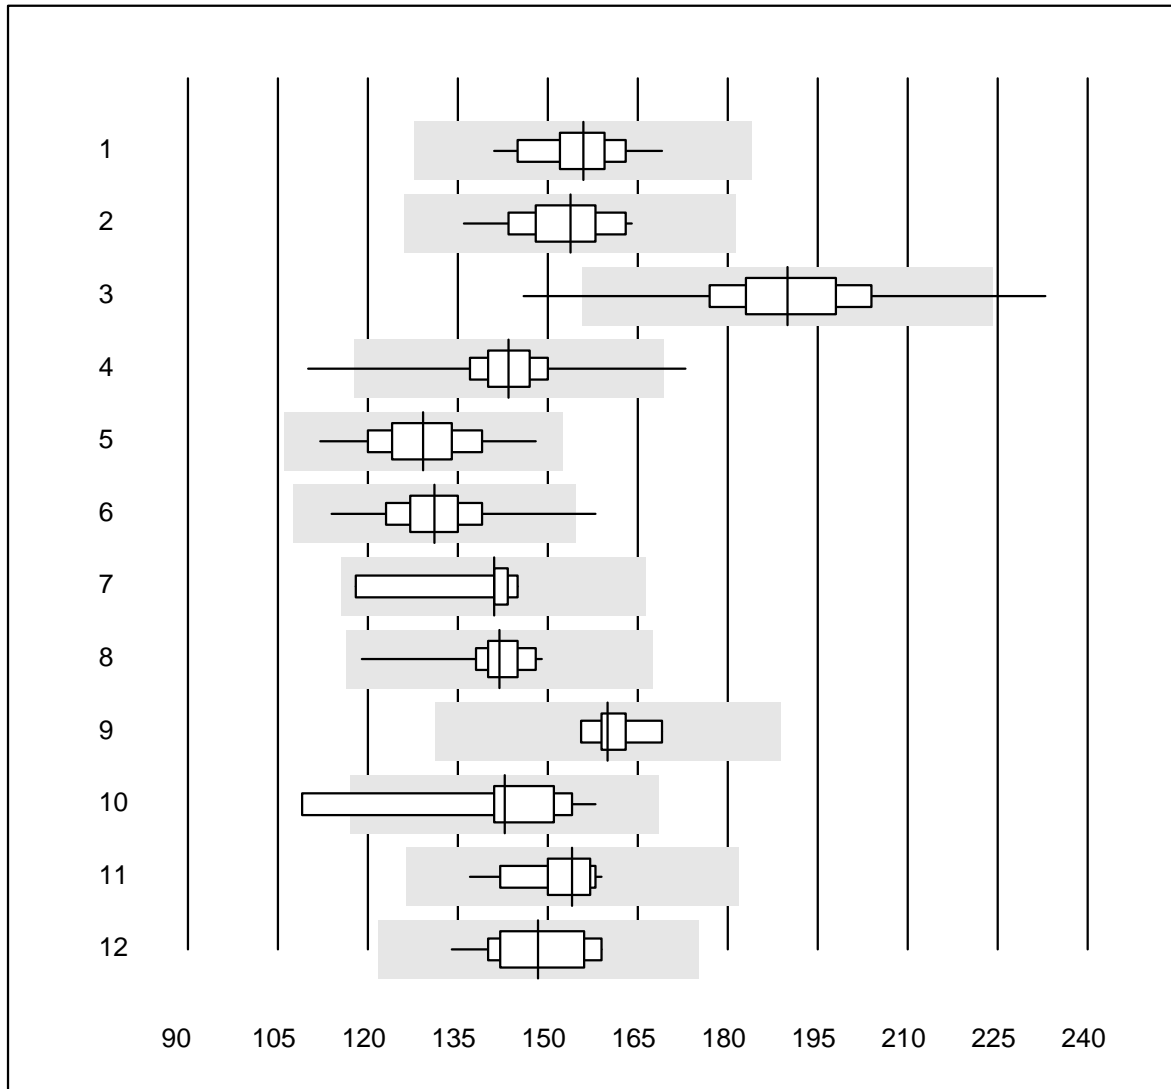


Tolérance QUALAB : 18 %

Transaminase GOT/AST (U/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 IFCC avec PP	30	100.0	0.0	0.0	156	4.1	e
2 Cobas	11	100.0	0.0	0.0	154	5.4	e
3 Reflotron	803	97.6	0.9	1.5	190	6.0	e
4 Fuji Dri-Chem	795	99.6	0.3	0.1	143	3.9	e
5 Spotchem/Ready	125	100.0	0.0	0.0	129	5.5	e
6 Spotchem D-Concept	202	98.5	1.5	0.0	131	5.1	e
7 IFCC sens PP	9	100.0	0.0	0.0	141	5.9	e
8 Piccolo	41	100.0	0.0	0.0	142	3.7	e
9 Skyla	6	100.0	0.0	0.0	160	2.9	e
10 Abx Mira	10	90.0	10.0	0.0	143	9.7	e*
11 Hitachi S40/M40	20	100.0	0.0	0.0	154	3.7	e
12 Autolyser/DiaSys	17	100.0	0.0	0.0	148	5.6	e

Transaminase GPT/ALT

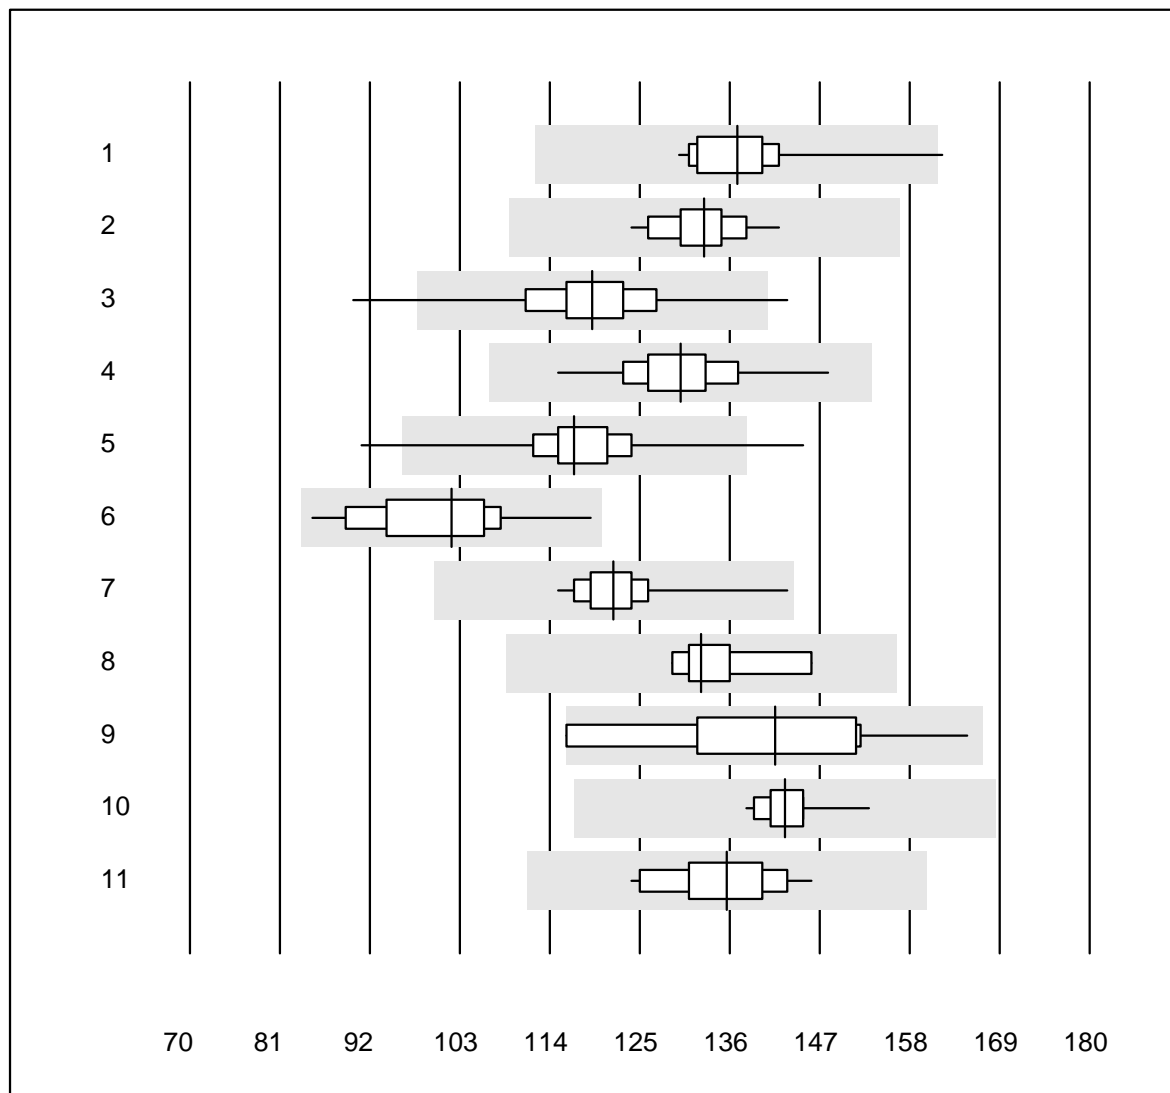


Tolérance QUALAB : 18 %

Transaminase GPT/ALT (U/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	IFCC avec PP	29	96.6	3.4	0.0	137	4.7	e
2	Cobas	20	100.0	0.0	0.0	133	3.5	e
3	Reflotron	834	98.3	1.0	0.7	119	5.6	e
4	Fuji Dri-Chem	813	99.6	0.0	0.4	130	4.0	e
5	Spotchem/Ready	130	97.7	1.5	0.8	117	5.2	e
6	Spotchem D-Concept	206	100.0	0.0	0.0	102	7.3	e
7	Piccolo	42	100.0	0.0	0.0	122	4.0	e
8	Skyla	6	100.0	0.0	0.0	133	4.5	e
9	Abx Mira	10	90.0	10.0	0.0	142	9.6	e*
10	Hitachi S40/M40	20	100.0	0.0	0.0	143	2.2	e
11	Autolyser/DiaSys	17	100.0	0.0	0.0	136	4.7	e

Triglycérides

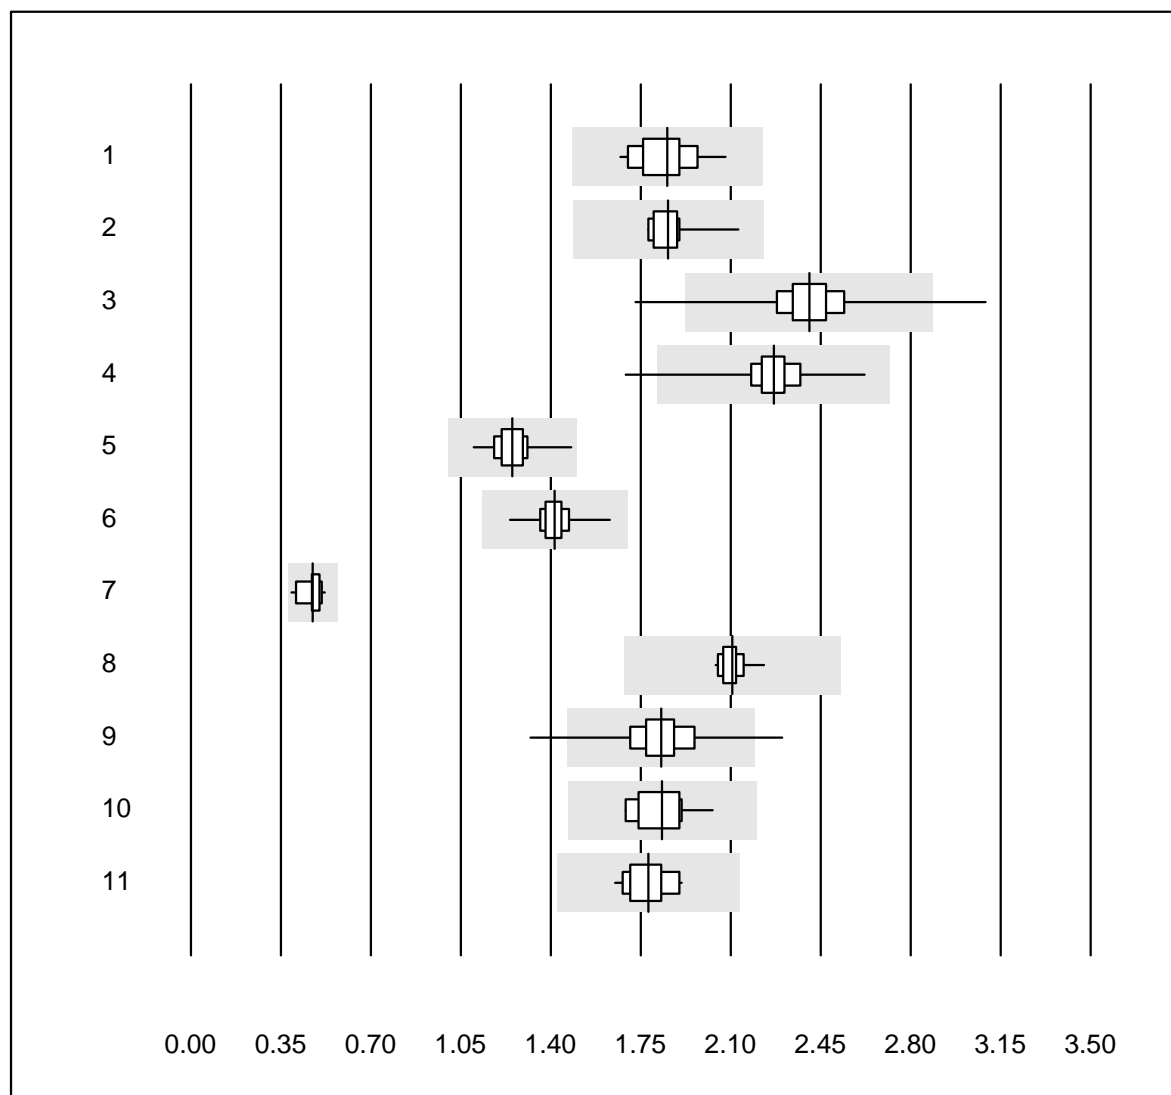


Tolérance QUALAB : 20 %

Triglycérides (mmol/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	28	100.0	0.0	0.0	1.85	5.4	e
2	Cobas	18	100.0	0.0	0.0	1.86	4.3	e
3	Reflotron	551	97.8	0.9	1.3	2.41	5.2	e
4	Fuji Dri-Chem	709	99.6	0.4	0.0	2.27	3.7	e
5	Spotchem/Ready	108	99.1	0.0	0.9	1.25	5.1	e
6	Spotchem D-Concept	183	97.8	0.0	2.2	1.41	3.4	e
7	Hitachi S40/M40	16	100.0	0.0	0.0	0.47	7.3	e
8	Piccolo	20	100.0	0.0	0.0	2.11	2.1	e
9	Cholestech LDX	178	97.8	1.1	1.1	1.83	5.6	e
10	Abx Mira	10	100.0	0.0	0.0	1.83	5.7	e
11	Autolyser/DiaSys	16	93.7	0.0	6.3	1.78	4.4	e

Lithium

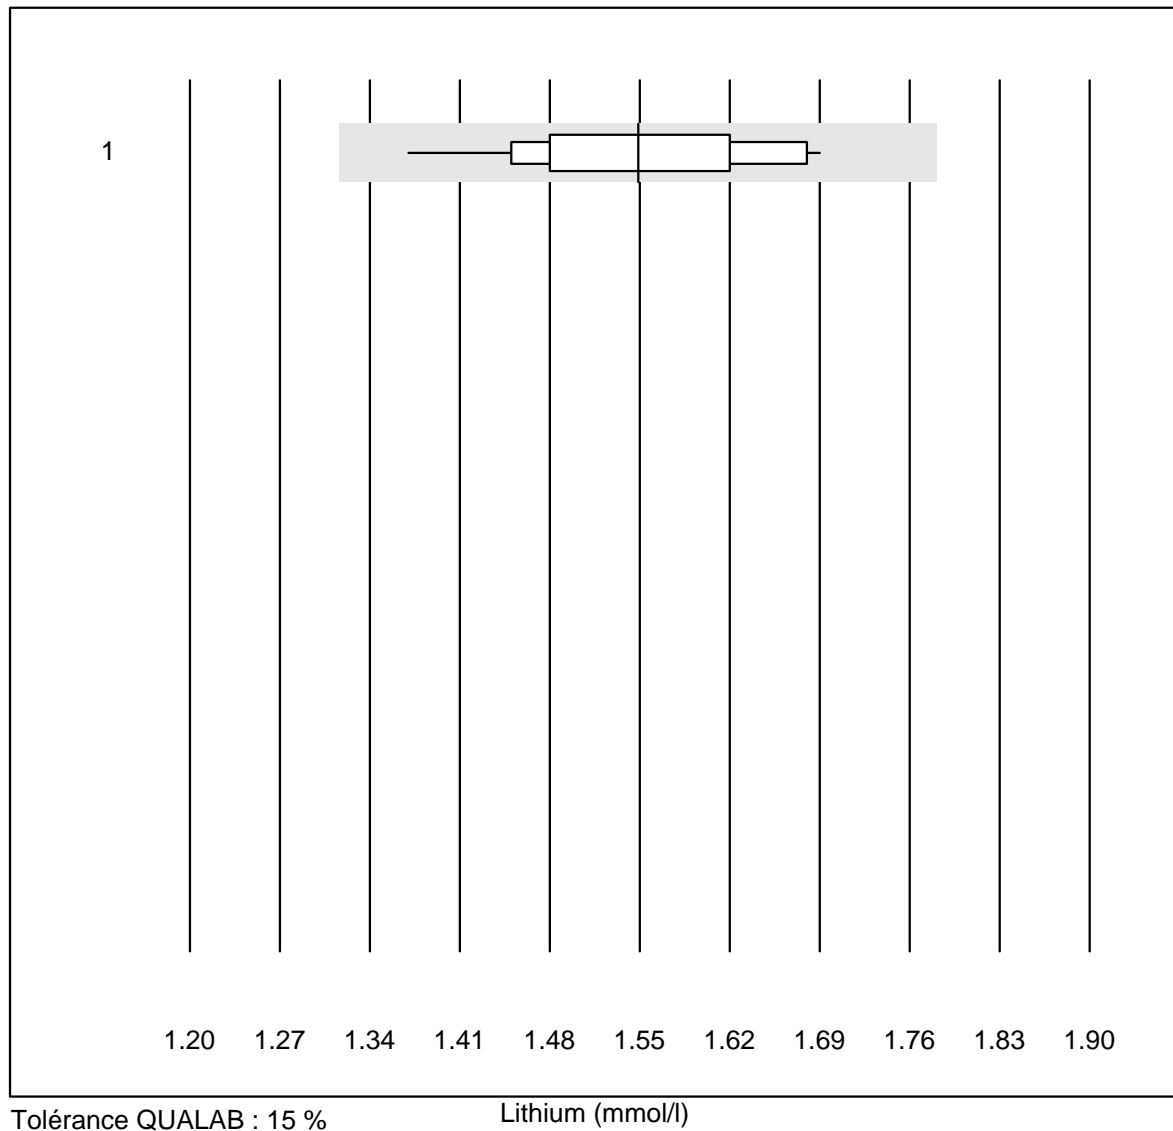


No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 toutes les méthodes	18	100.0	0.0	0.0	1.55	5.8	e

Laktat

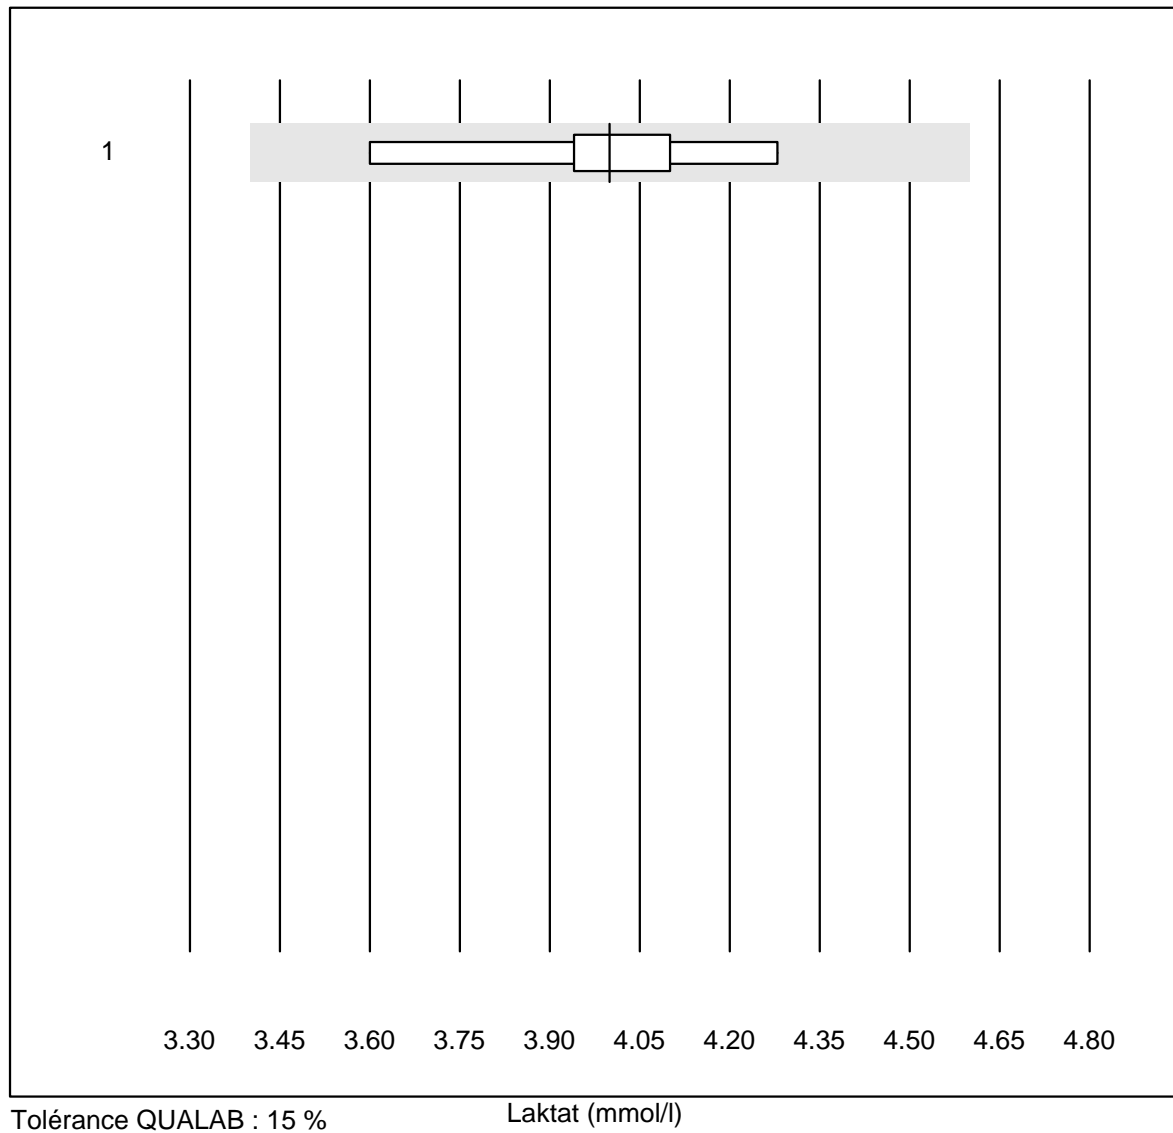

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 toutes les méthodes	9	100.0	0.0	0.0	4.00	5.0	e

HbA1c échantillon A

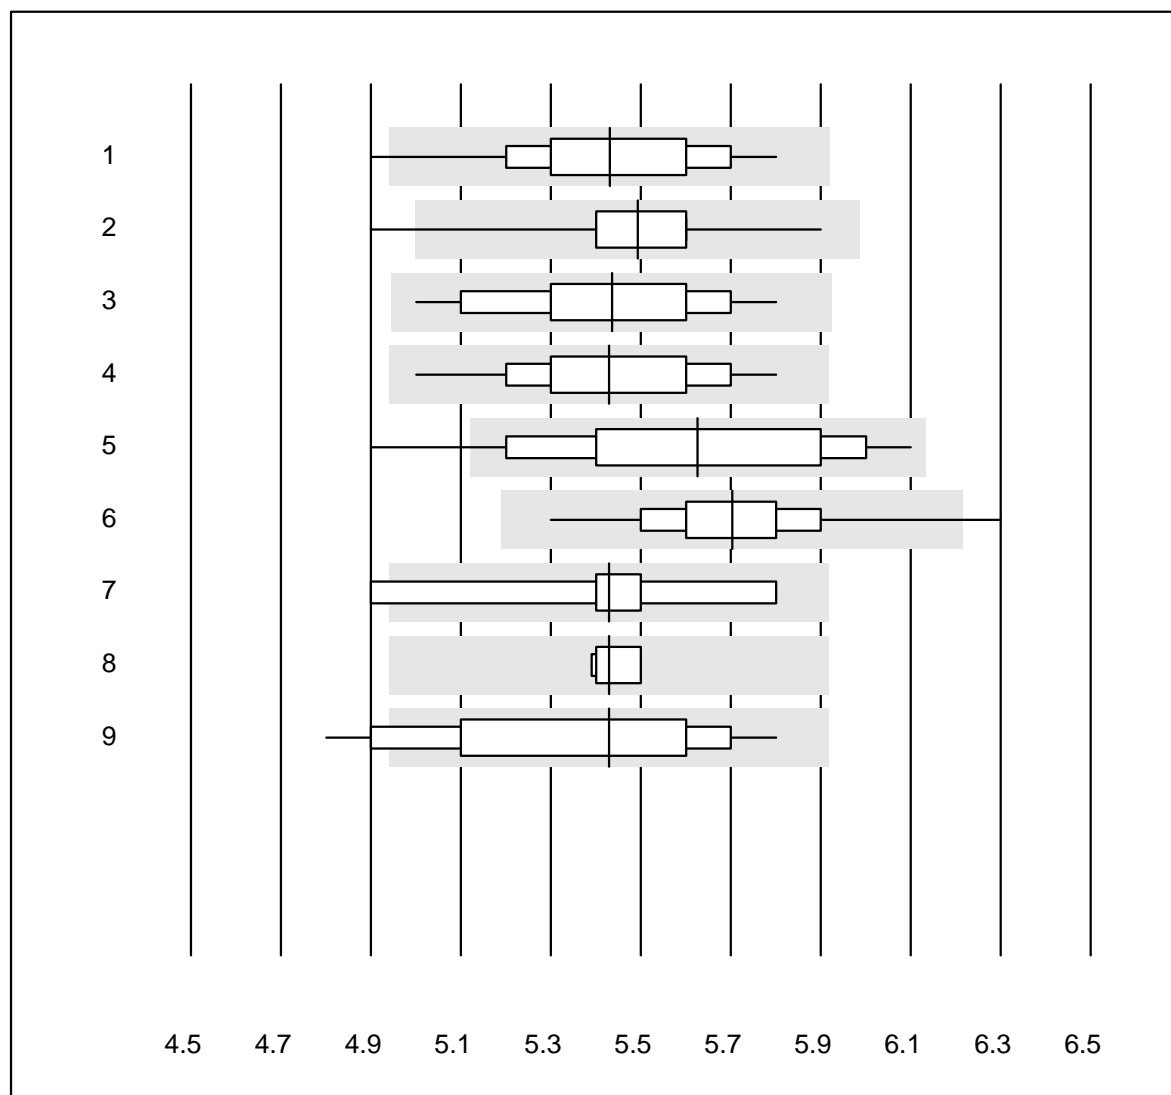


Tolérance QUALAB : 9 %

HbA1c échantillon A (%)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas b101	46	95.6	2.2	2.2	5.4	3.7	e
2	Afinion	634	99.6	0.2	0.2	5.5	2.2	e
3	Eurolyser	18	94.4	0.0	5.6	5.4	4.1	e
4	Hemocue HbA1c 501	11	100.0	0.0	0.0	5.4	4.4	a
5	NycoCard	76	92.1	6.6	1.3	5.6	5.4	e
6	DCA2000/Vantage	207	98.5	1.0	0.5	5.7	3.1	e
7	Andere	9	88.9	11.1	0.0	5.4	4.9	a
8	HPLC	7	85.7	0.0	14.3	5.4	1.0	a
9	Roche, Cobas	13	84.6	15.4	0.0	5.4	5.9	a


HbA1c échantillon B

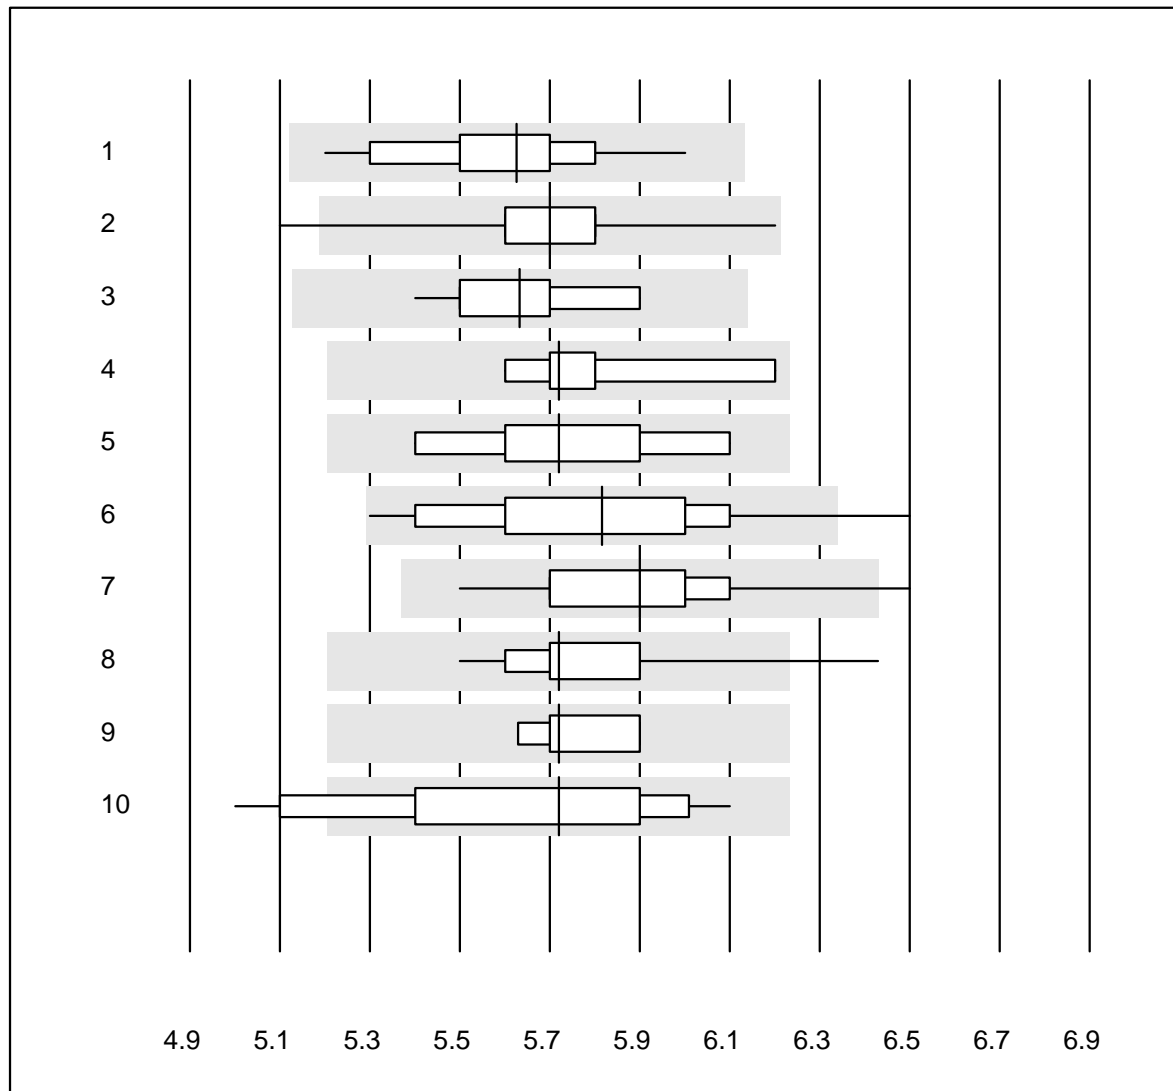

Tolérance QUALAB : 9 %


HbA1c échantillon B (%)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas b101	34	100.0	0.0	0.0	5.6	3.3	e
2	Afinion	664	99.5	0.2	0.3	5.7	2.0	e
3	Eurolyser	19	94.7	0.0	5.3	5.6	2.4	e
4	A1c Now	5	100.0	0.0	0.0	5.7	3.9	a
5	Hemocue HbA1c 501	6	83.3	0.0	16.7	5.7	4.7	a
6	NycoCard	41	92.7	2.4	4.9	5.8	4.8	e
7	DCA2000/Vantage	231	98.3	0.4	1.3	5.9	3.1	e
8	Andere	11	90.9	9.1	0.0	5.7	4.1	a
9	HPLC	8	87.5	0.0	12.5	5.7	1.8	a
10	Roche, Cobas	16	81.2	12.5	6.3	5.7	5.9	a

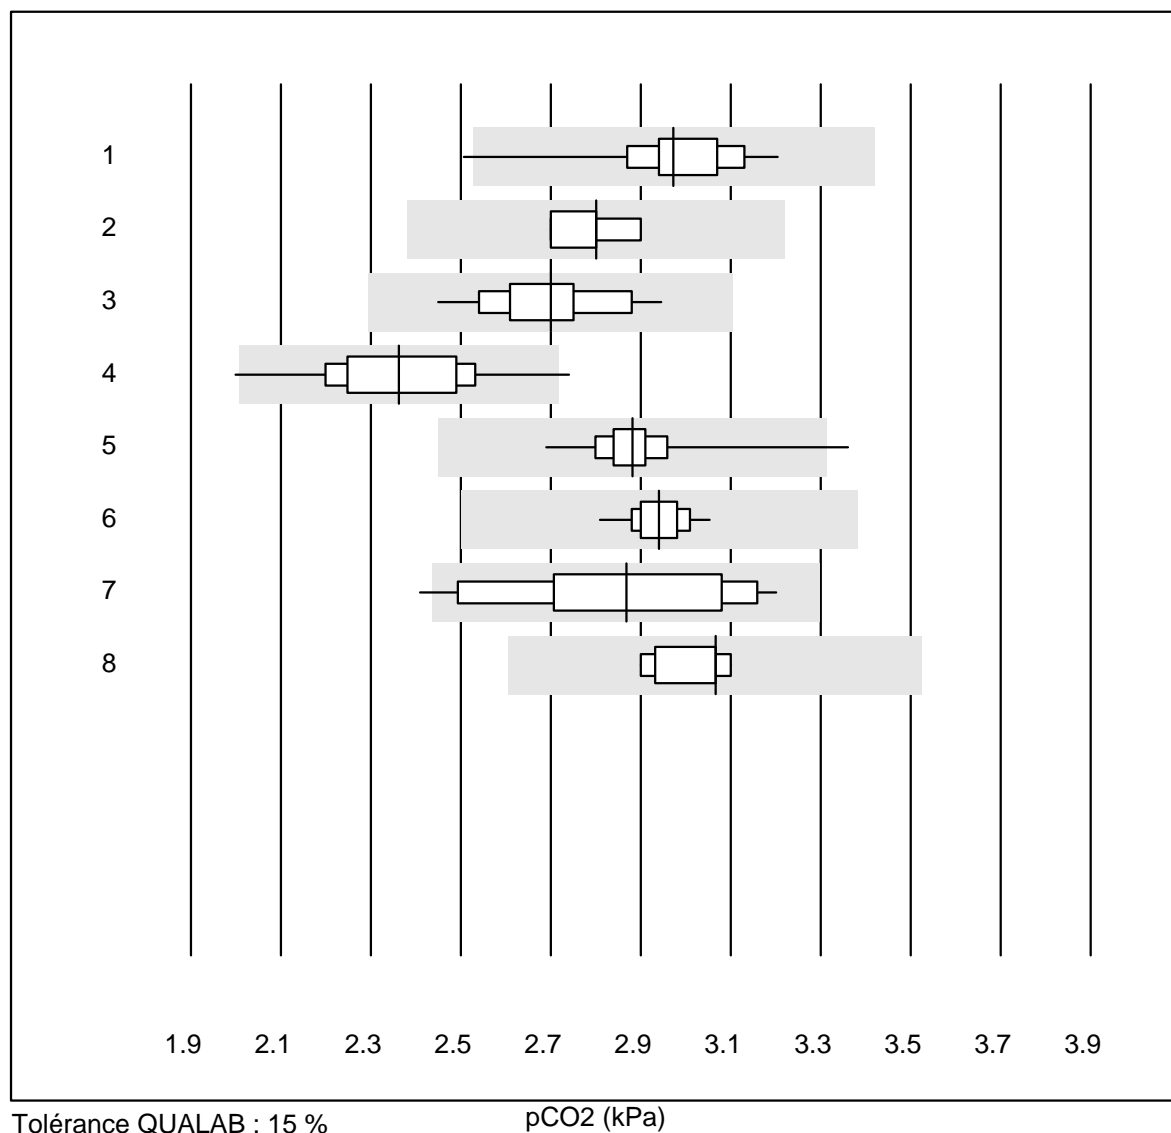pCO₂


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas	22	95.5	4.5	0.0	2.97	5.4	e
2	IL	4	100.0	0.0	0.0	2.80	2.9	e
3	iStat	39	97.4	0.0	2.6	2.70	4.5	e
4	EPOC	37	81.1	5.4	13.5	2.36	6.6	e
5	ABL700/800	79	97.4	1.3	1.3	2.88	2.8	e
6	ABL 90	35	100.0	0.0	0.0	2.94	1.9	e
7	ABL 80 / Coox	26	96.2	3.8	0.0	2.87	8.2	e
8	ABL 5	5	100.0	0.0	0.0	3.07	3.0	e

pO2

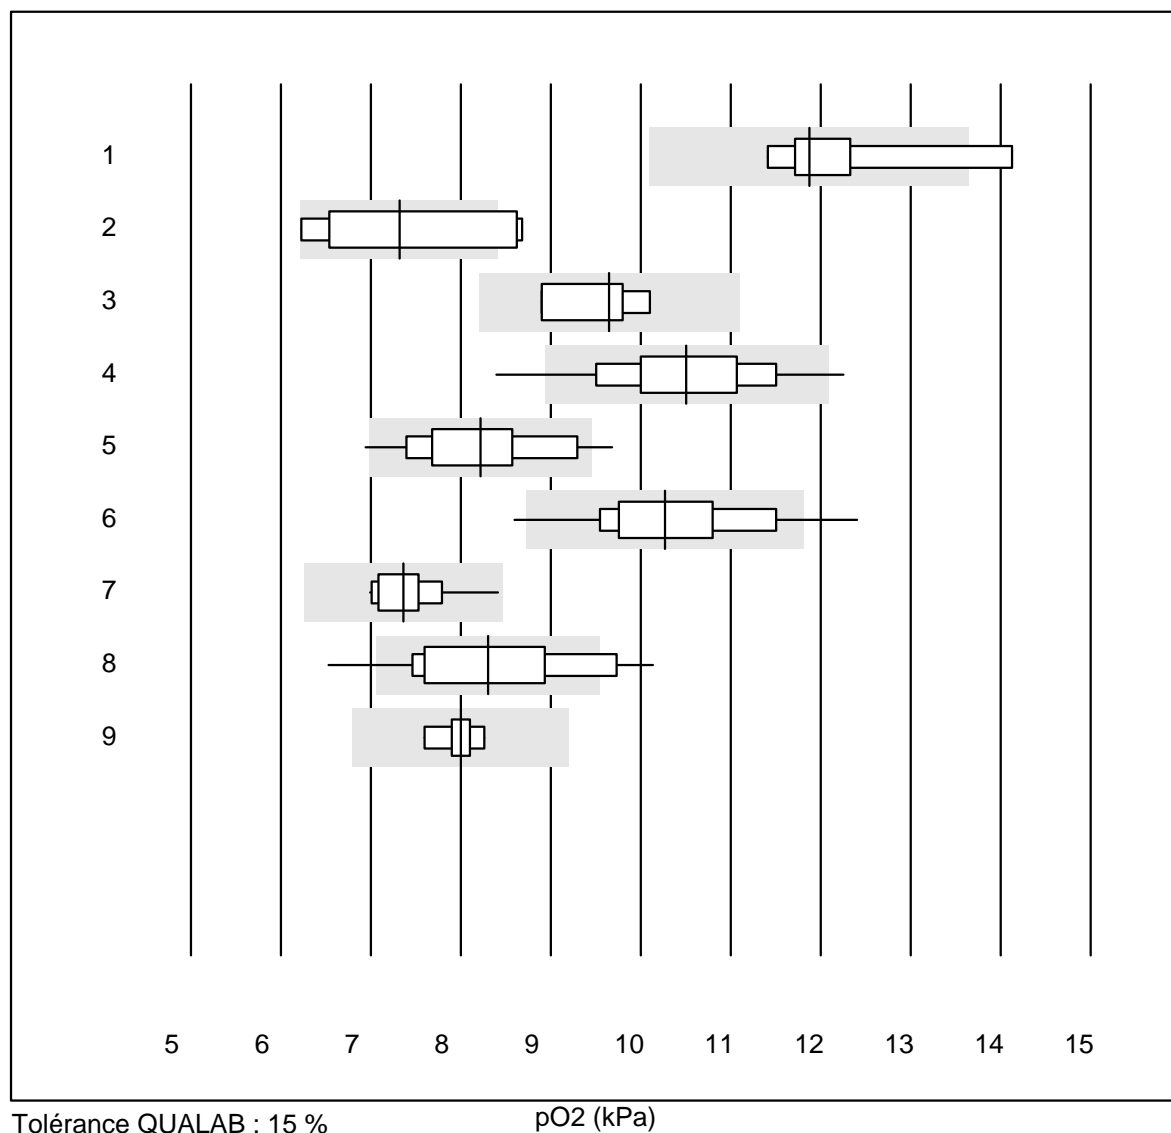

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas b221	9	88.9	11.1	0.0	11.87	6.7	e*
2	Cobas b121/123	9	55.6	22.2	22.2	7.32	13.9	e*
3	IL	4	100.0	0.0	0.0	9.65	5.4	e*
4	iStat	39	82.0	7.7	10.3	10.51	7.9	e
5	EPOC	37	73.0	5.4	21.6	8.22	8.0	e
6	ABL700/800	79	87.4	6.3	6.3	10.27	7.6	e
7	ABL 90	35	85.7	0.0	14.3	7.36	5.0	e
8	ABL 80 / Coox	26	65.4	15.4	19.2	8.30	11.1	e*
9	ABL 5	5	100.0	0.0	0.0	8.00	3.1	e

pH

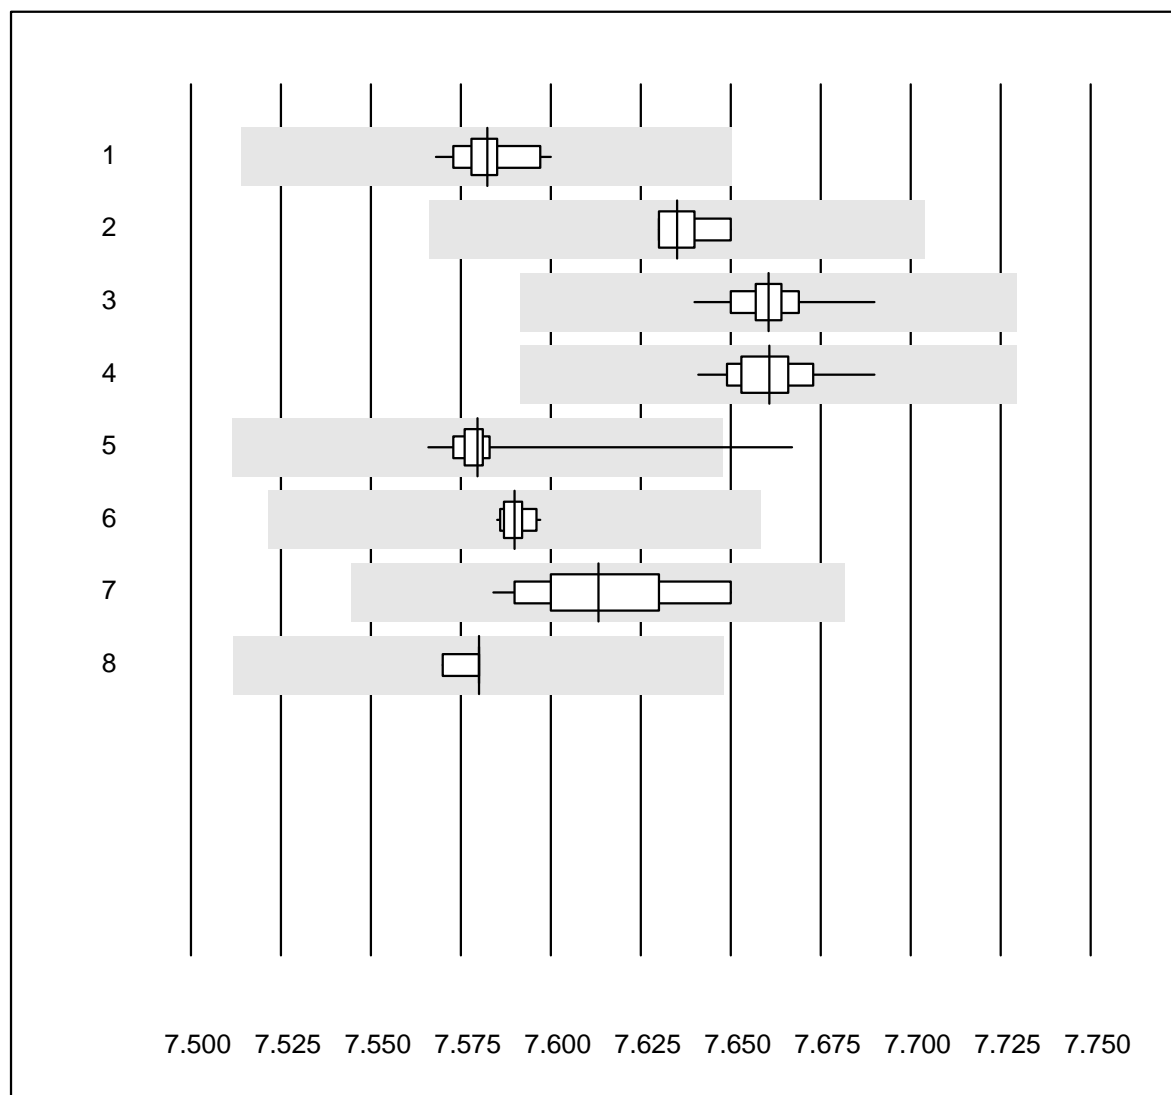


Tolérance QUALAB : 1 %

pH ()

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas	21	100.0	0.0	0.0	7.58	0.1	e
2	IL	4	100.0	0.0	0.0	7.64	0.1	e
3	iStat	40	97.5	0.0	2.5	7.66	0.1	e
4	EPOC	37	100.0	0.0	0.0	7.66	0.1	e
5	ABL700/800	80	98.7	1.3	0.0	7.58	0.1	e
6	ABL 90	35	100.0	0.0	0.0	7.59	0.0	e
7	ABL 80 / Coox	26	100.0	0.0	0.0	7.61	0.3	e
8	ABL 5	5	100.0	0.0	0.0	7.58	0.1	e

Glucose GS

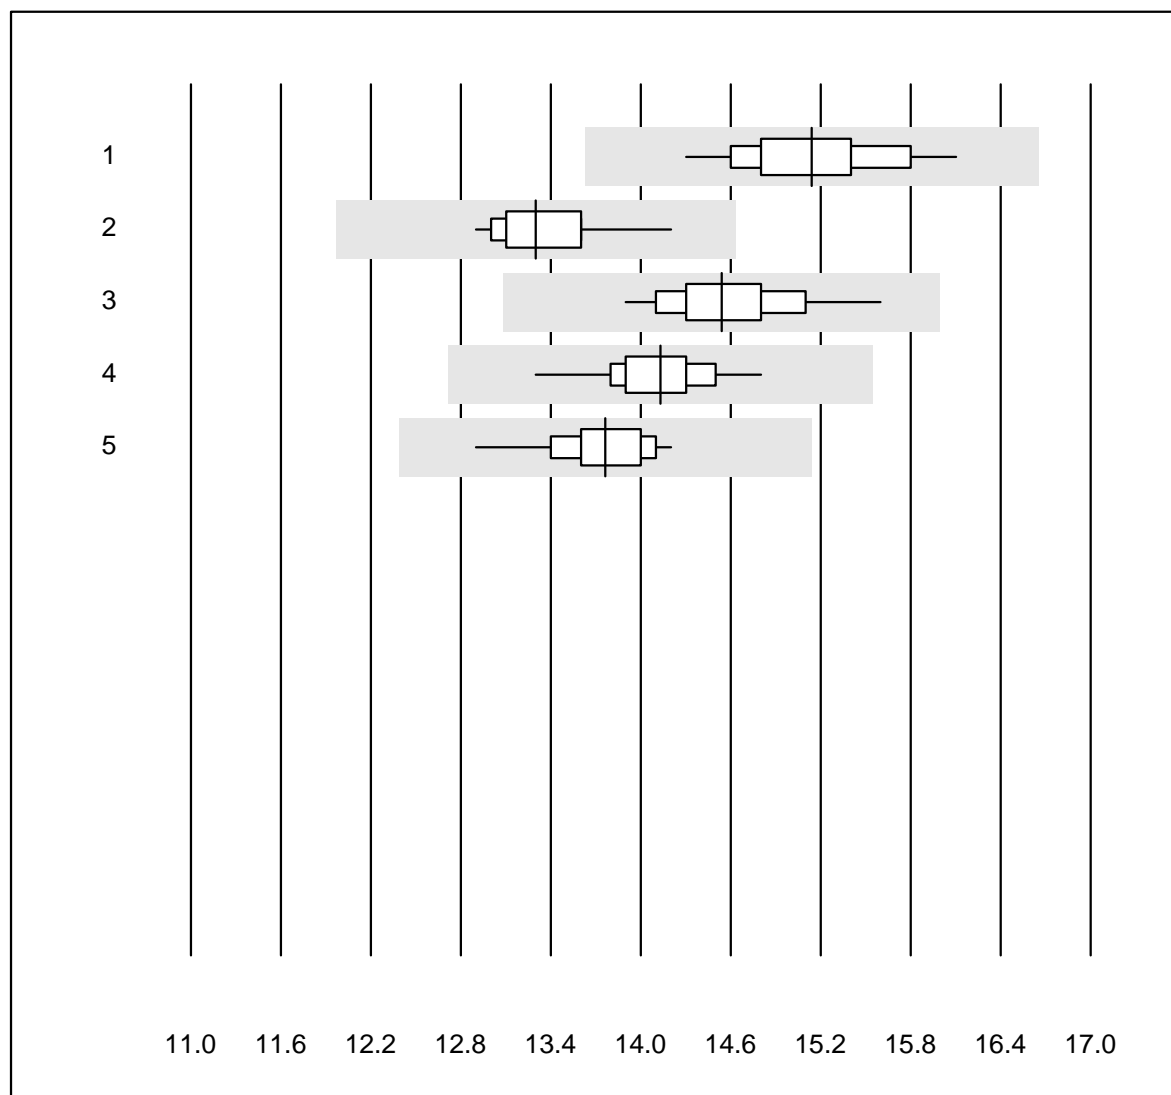


Tolérance QUALAB : 10 %

Glucose GS (mmol/l)

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas	13	100.0	0.0	0.0	15.1	3.4	e
2 iStat	11	100.0	0.0	0.0	13.3	2.8	e
3 EPOC	26	100.0	0.0	0.0	14.5	2.8	e
4 ABL700/800	67	98.5	0.0	1.5	14.1	2.1	e
5 ABL 90	36	100.0	0.0	0.0	13.8	2.1	e

Hémoglobine BG

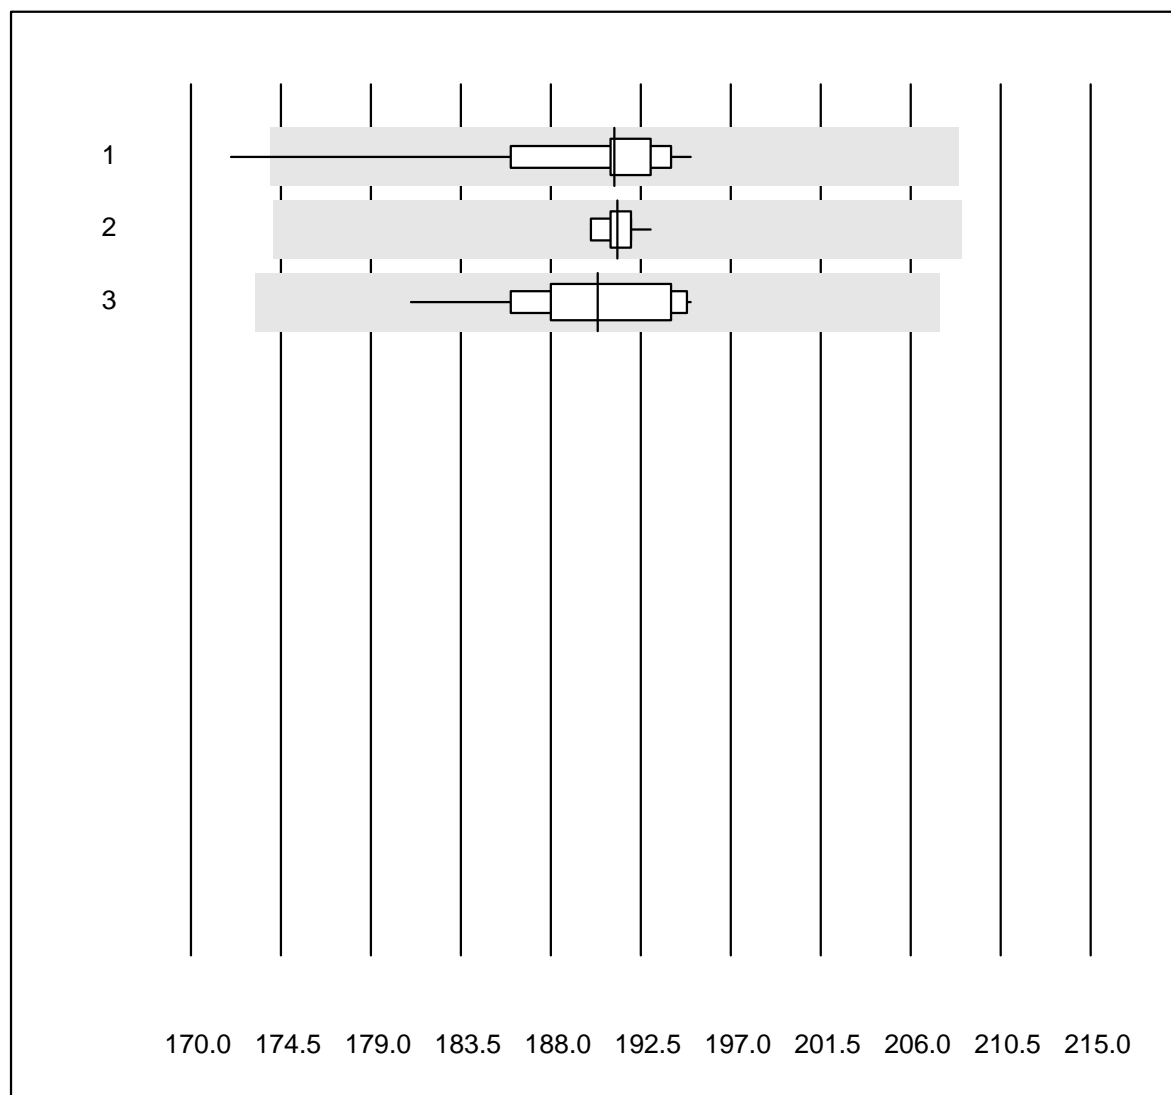


Tolérance QUALAB : 9 %

Hémoglobine BG (g/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ABL700/800	68	98.5	1.5	0.0	191.2	2.2	e
2 ABL 90	34	100.0	0.0	0.0	191.3	0.4	e
3 ABL 80 / Coox	18	94.4	0.0	5.6	190.3	2.0	e

Potassium BG

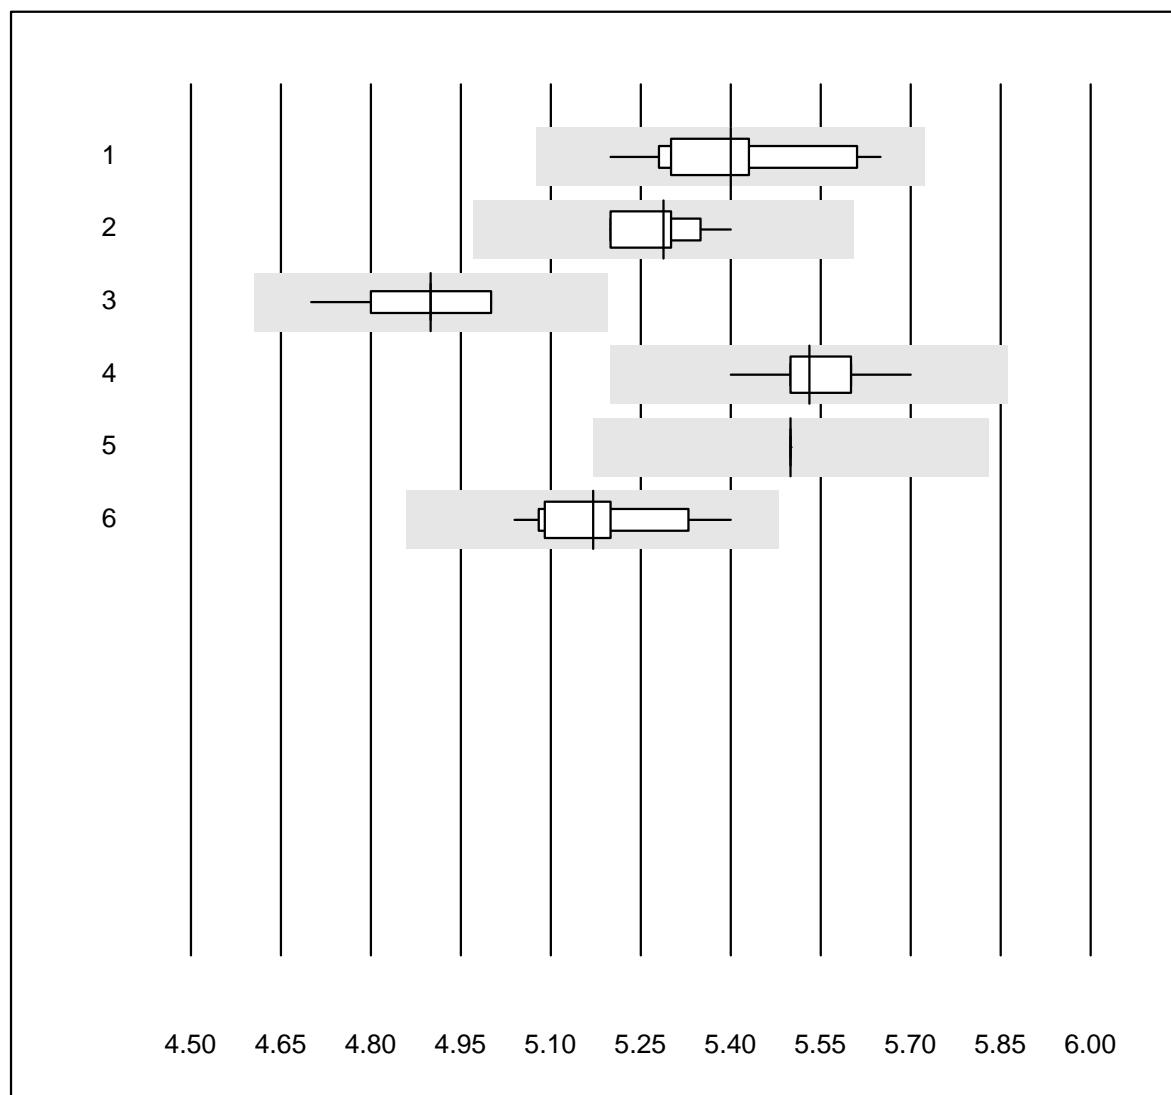


Tolérance QUALAB : 6 %

Potassium BG (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas	21	100.0	0.0	0.0	5.4	2.5	e
2	iStat	20	100.0	0.0	0.0	5.3	1.1	e
3	EPOC	30	96.7	0.0	3.3	4.9	1.5	e
4	ABL700/800	69	98.6	0.0	1.4	5.5	1.1	e
5	ABL 90	35	100.0	0.0	0.0	5.5	0.0	e
6	ABL 80 / Coox	11	100.0	0.0	0.0	5.2	2.2	e

Sodium BG

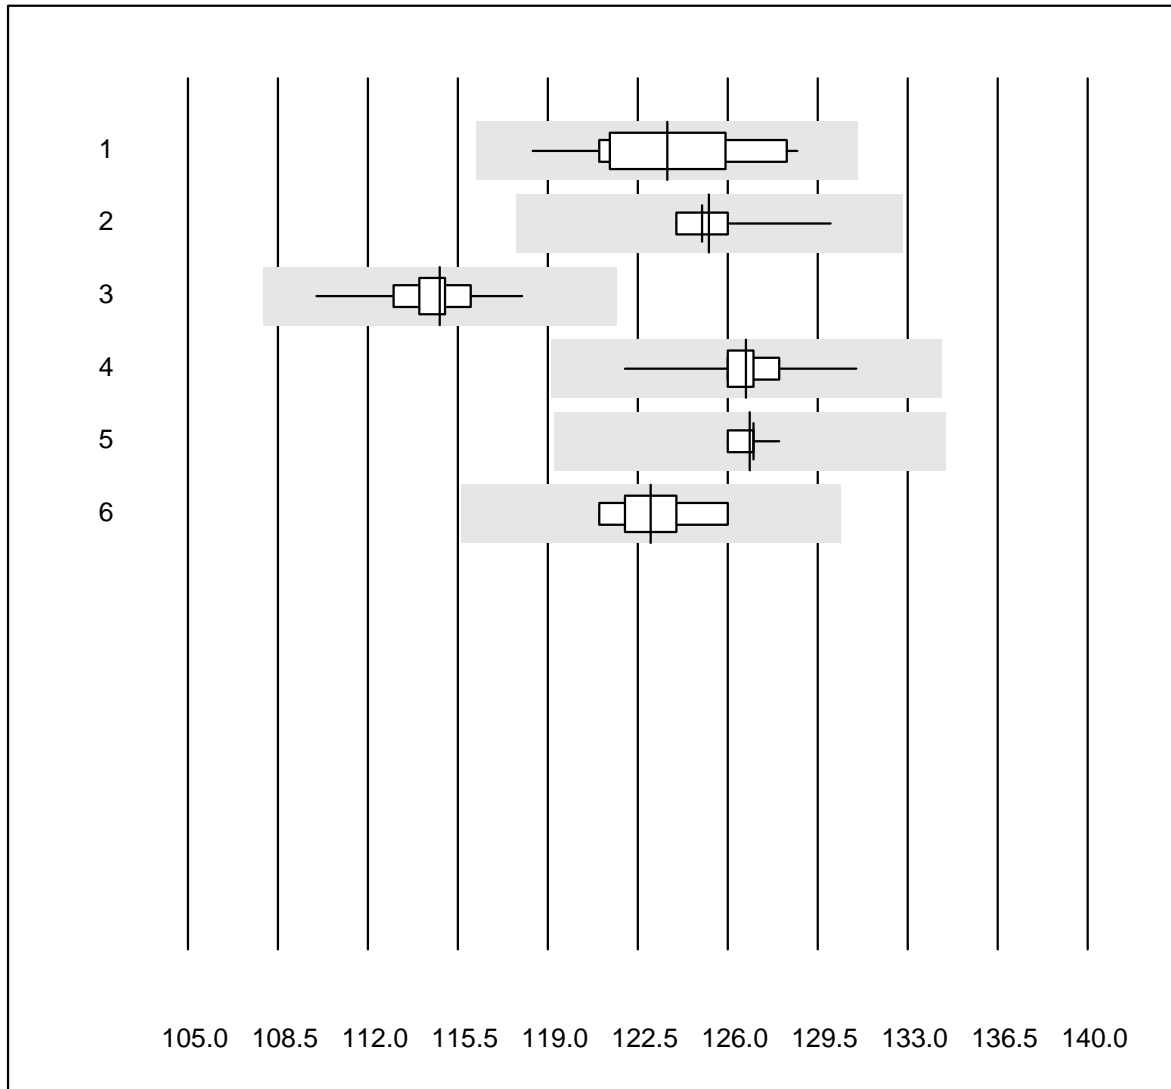


Tolérance QUALAB : 6 %

Sodium BG (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas	22	100.0	0.0	0.0	123.6	2.4	e
2	iStat	20	100.0	0.0	0.0	125.3	1.1	e
3	EPOC	29	100.0	0.0	0.0	114.8	1.3	e
4	ABL700/800	67	98.5	0.0	1.5	126.7	0.9	e
5	ABL 90	35	100.0	0.0	0.0	126.9	0.4	e
6	ABL 80 / Coox	9	100.0	0.0	0.0	123.0	1.3	e

Chlorure-BG

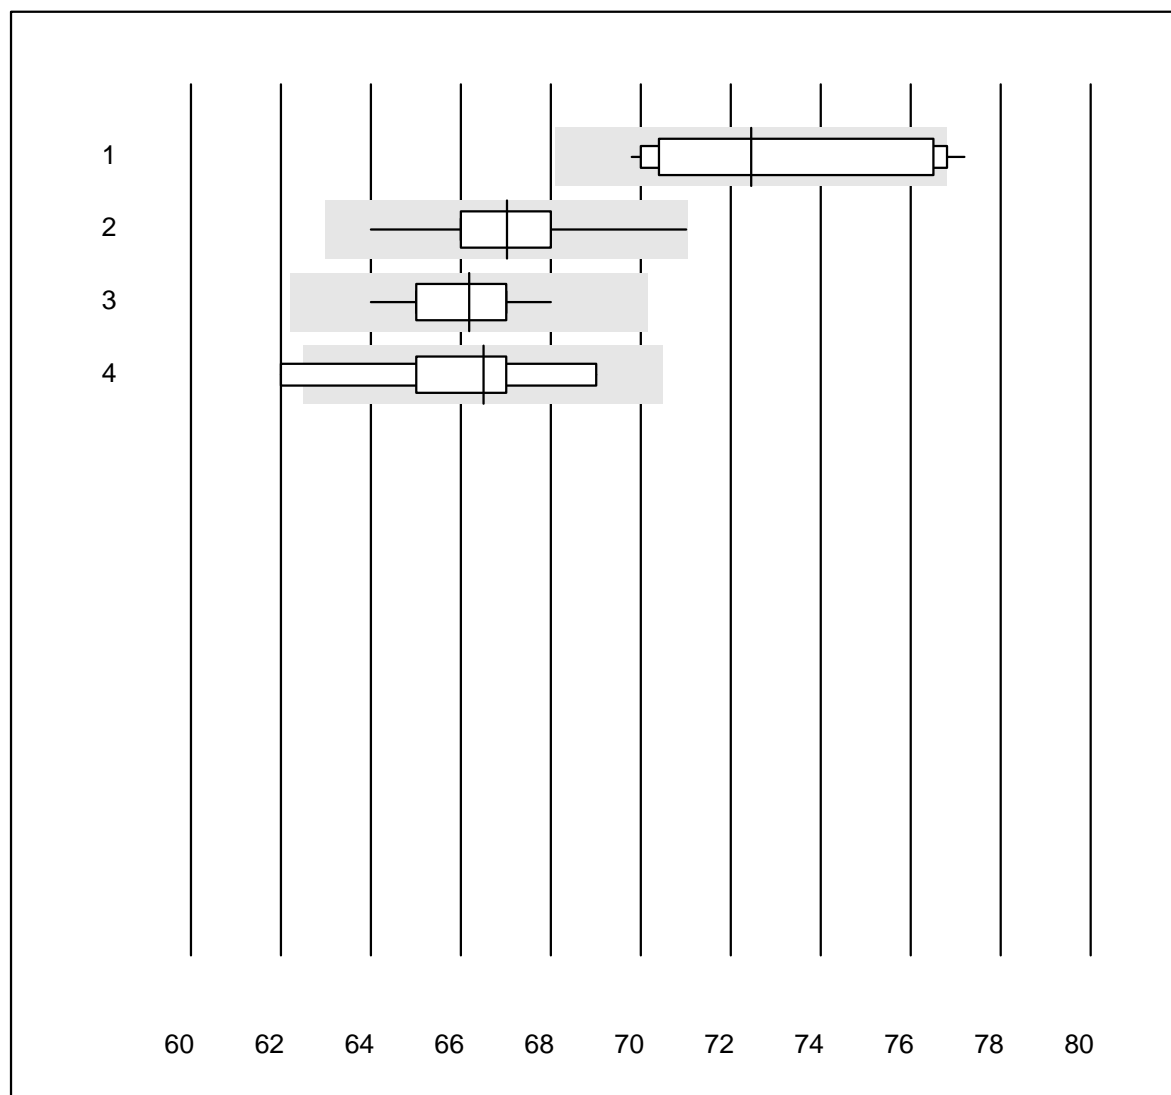


Tolérance QUALAB : 6 %

Chlorure-BG (mmol/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas	11	90.9	9.1	0.0	72.5	4.0	e*
2 ABL700/800	59	98.3	0.0	1.7	67.0	2.0	e
3 ABL 90	34	100.0	0.0	0.0	66.2	1.6	e
4 ABL 80 / Coox	8	62.5	12.5	25.0	66.5	3.6	e*

Calcium-BG

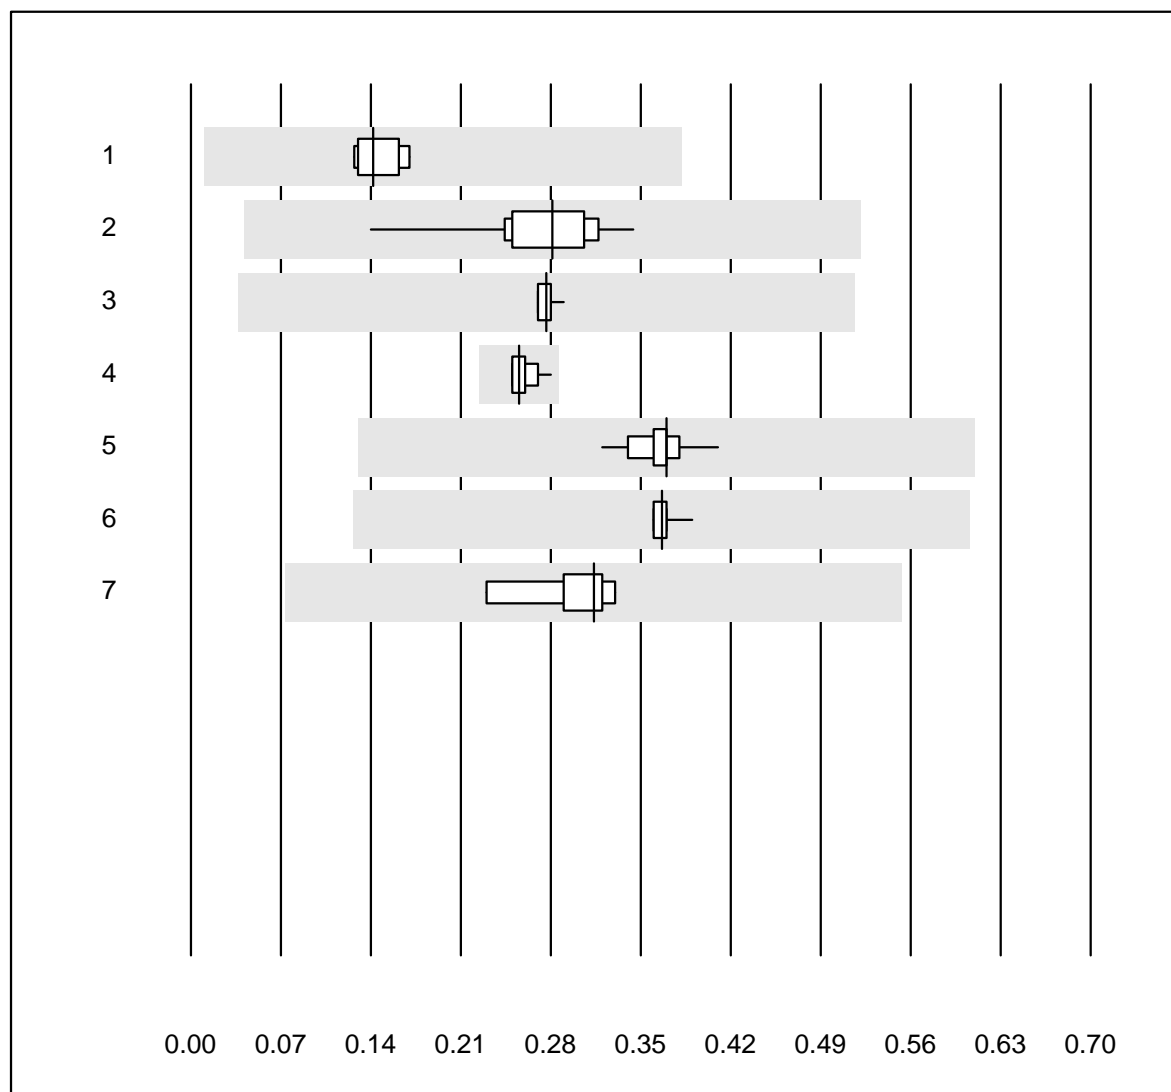


Tolérance QUALAB : 12 %
(< 2.00: +/- 0.24 mmol/l)

Calcium-BG (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas b123	6	100.0	0.0	0.0	0.14	12.3	e*
2	Cobas	14	100.0	0.0	0.0	0.28	17.5	e*
3	iStat	11	100.0	0.0	0.0	0.28	2.4	e
4	EPOC	29	96.6	0.0	3.4	0.26	3.1	e
5	ABL700/800	68	98.5	0.0	1.5	0.37	4.9	e
6	ABL 90	35	100.0	0.0	0.0	0.37	1.9	e
7	ABL 80 / Coox	10	100.0	0.0	0.0	0.31	11.3	e*

FHHb

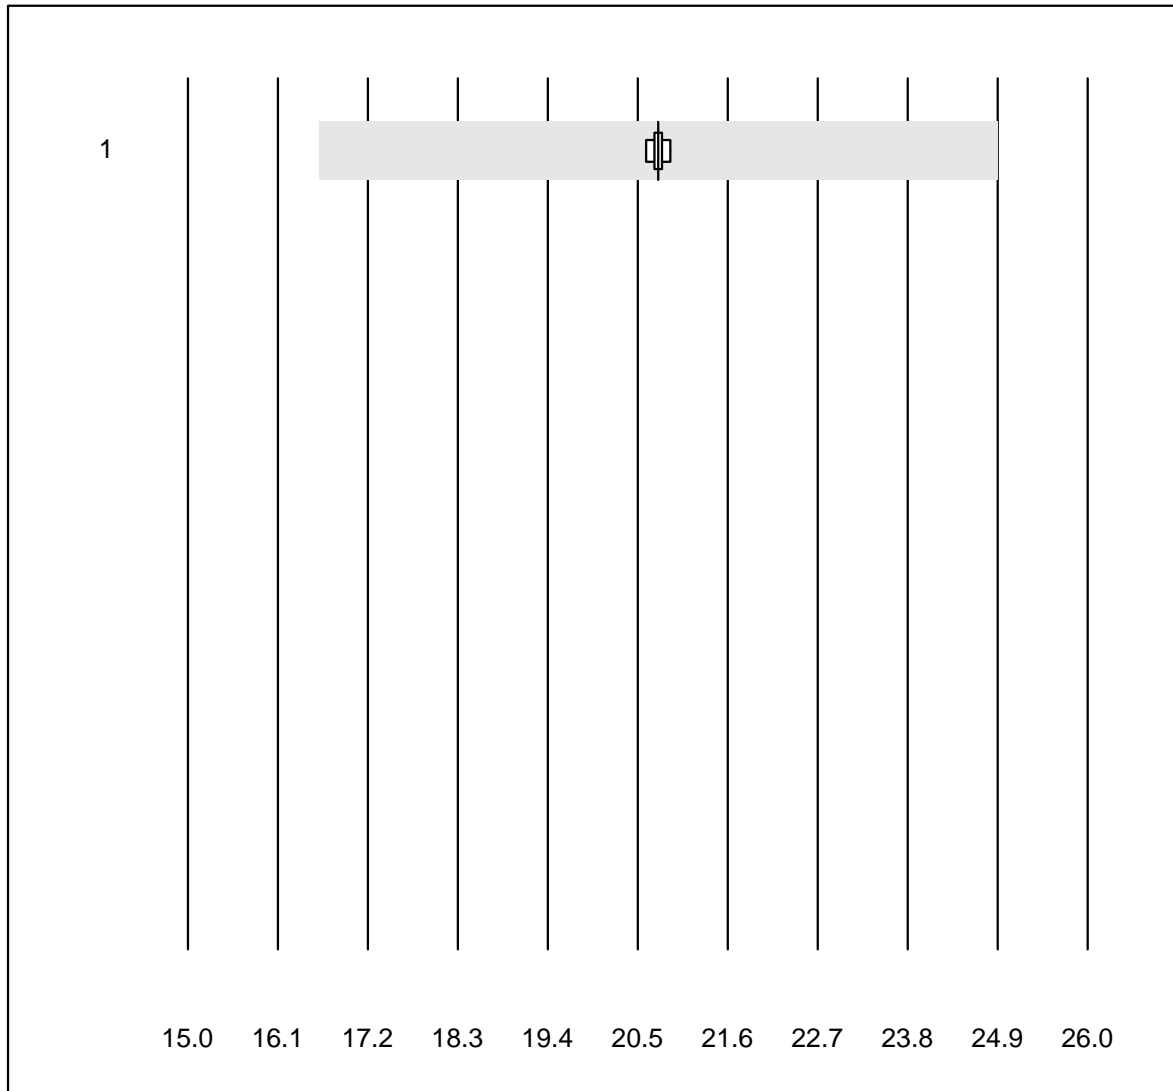


Tolérance QUALAB : 20 %

FHHb (%)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	ABL 80 / Coox	6	100.0	0.0	0.0	20.750	0.5	e

Lactate-BG

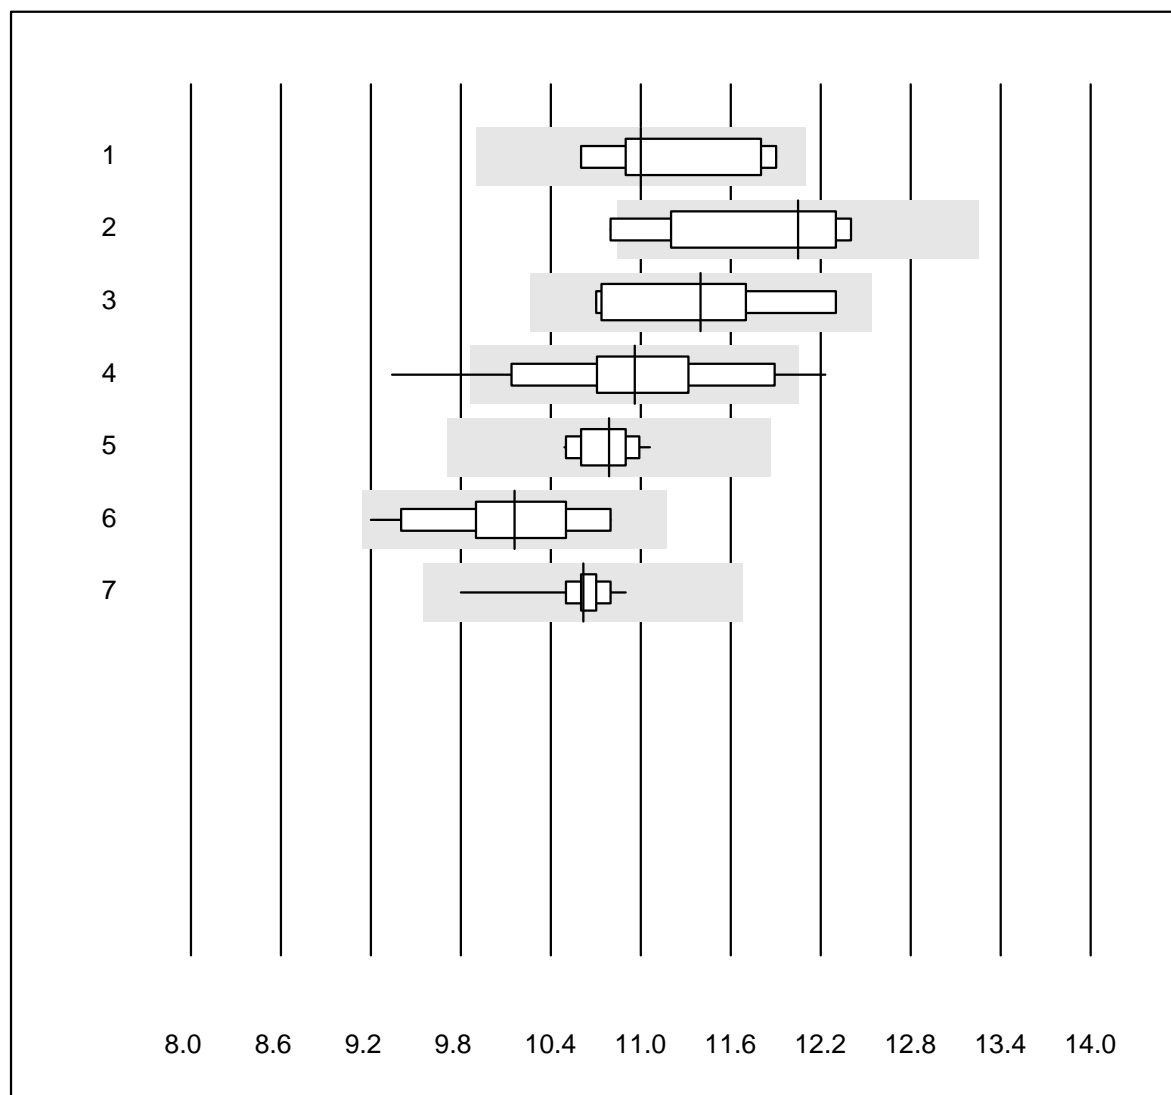


Tolérance QUALAB : 10 %

Lactate-BG (mmol/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas b123	7	100.0	0.0	0.0	11.00	4.4	e*
2	Cobas	6	83.3	16.7	0.0	12.05	5.5	e*
3	IL	5	100.0	0.0	0.0	11.40	5.9	e*
4	EPOC	31	74.1	6.5	19.4	10.96	5.9	e
5	iStat	11	100.0	0.0	0.0	10.79	1.7	e
6	ABL700/800	72	98.6	0.0	1.4	10.16	4.5	e
7	ABL 90	36	100.0	0.0	0.0	10.62	1.9	e

sO2 OR

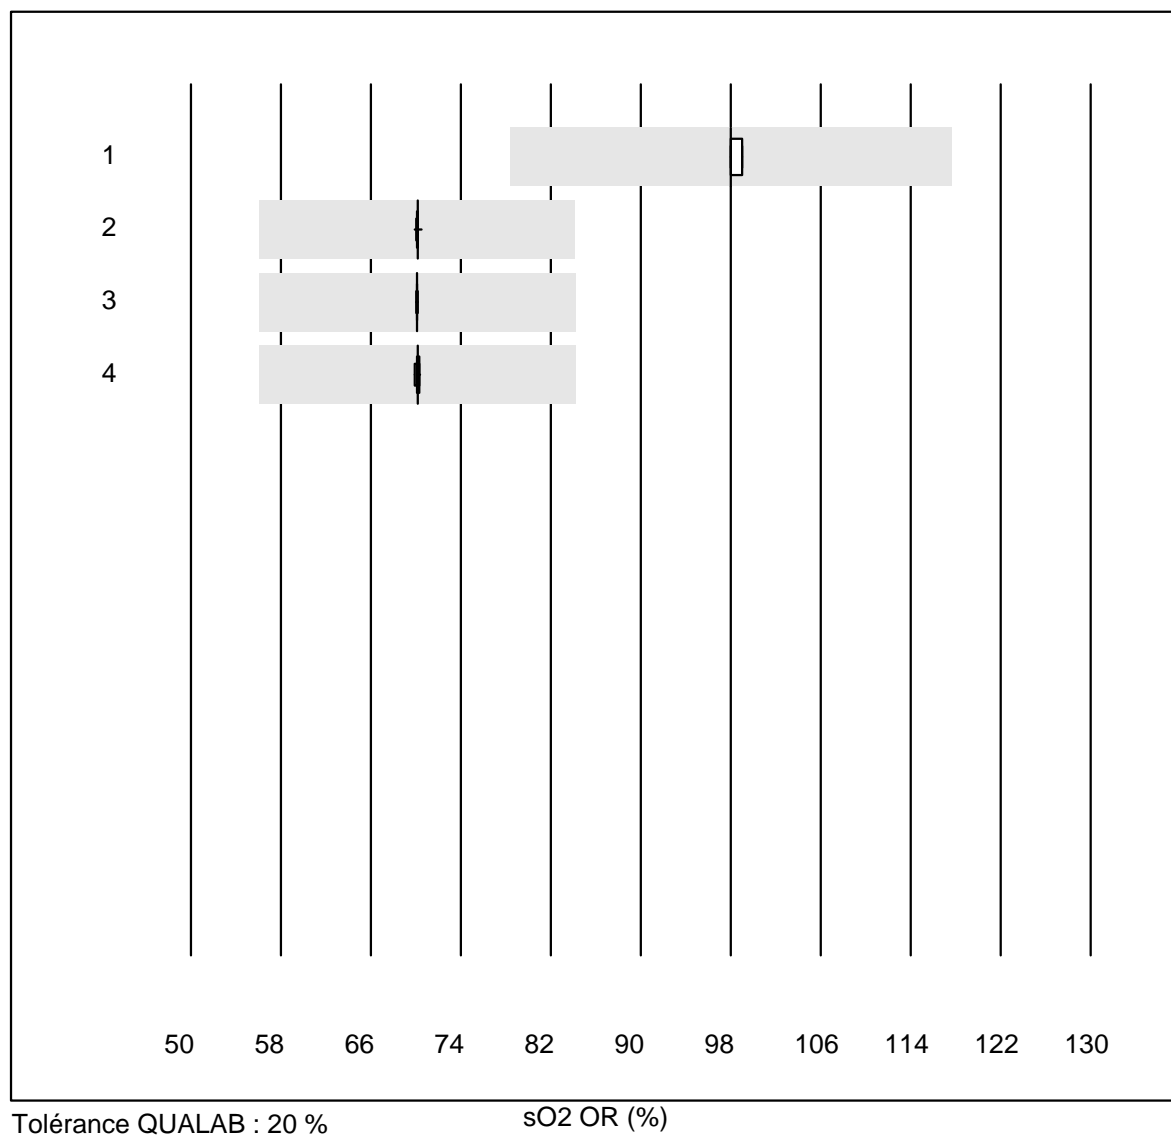

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 iStat	7	100.0	0.0	0.0	98.000	0.5	e
2 ABL700/800	55	100.0	0.0	0.0	70.144	0.1	e
3 ABL 90	31	100.0	0.0	0.0	70.103	0.1	e
4 ABL 80 / Coox	16	87.5	0.0	12.5	70.171	0.2	e

FO2Hb OR

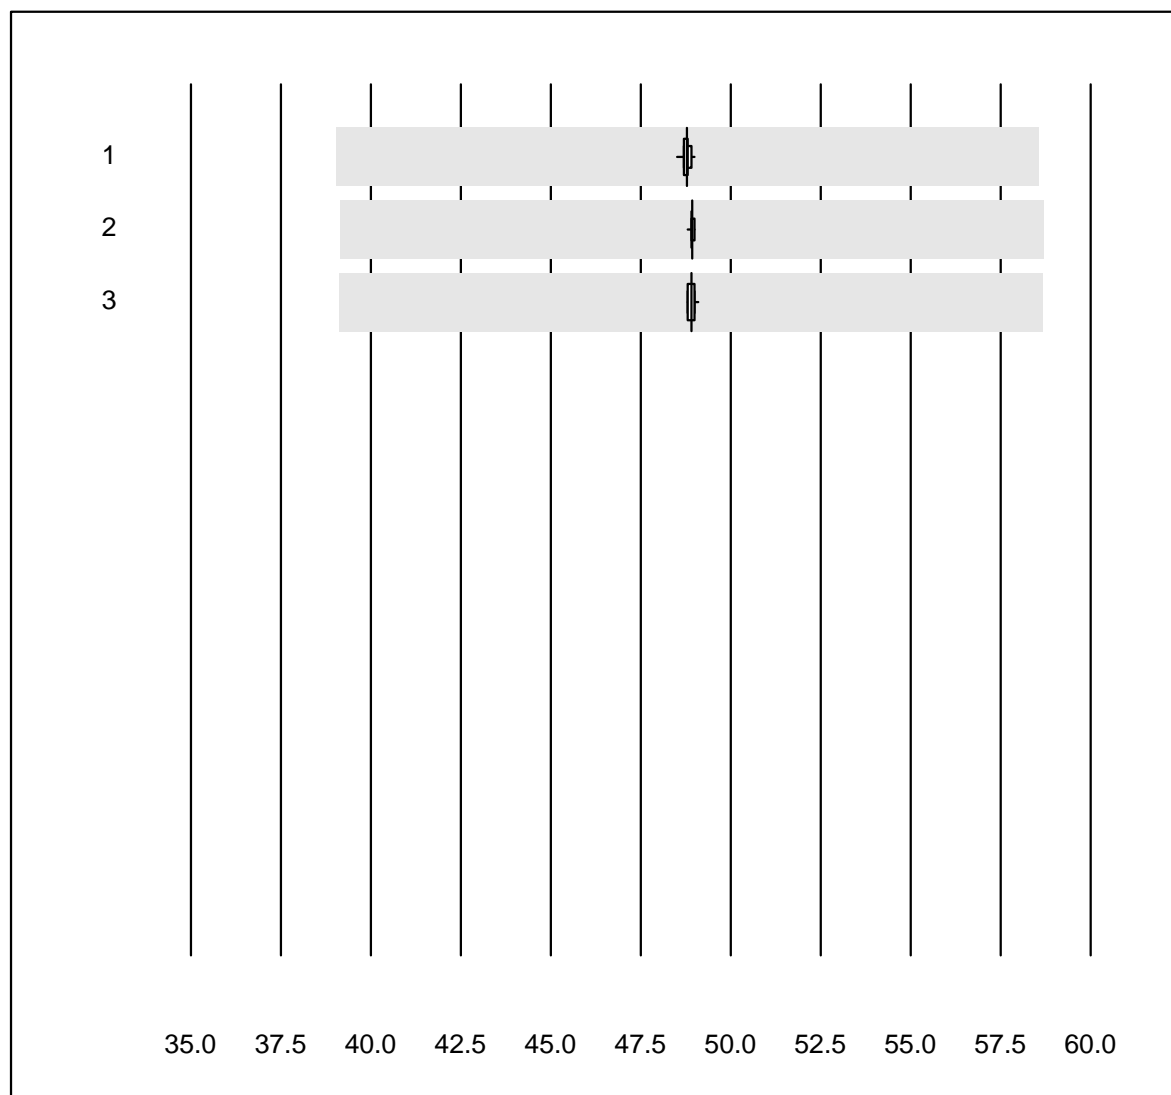


Tolérance QUALAB : 20 %

FO2Hb OR (%)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ABL700/800	49	100.0	0.0	0.0	48.786	0.2	e
2 ABL 90	32	100.0	0.0	0.0	48.922	0.1	e
3 ABL 80 / Coox	17	100.0	0.0	0.0	48.900	0.2	e

FCOHb OR

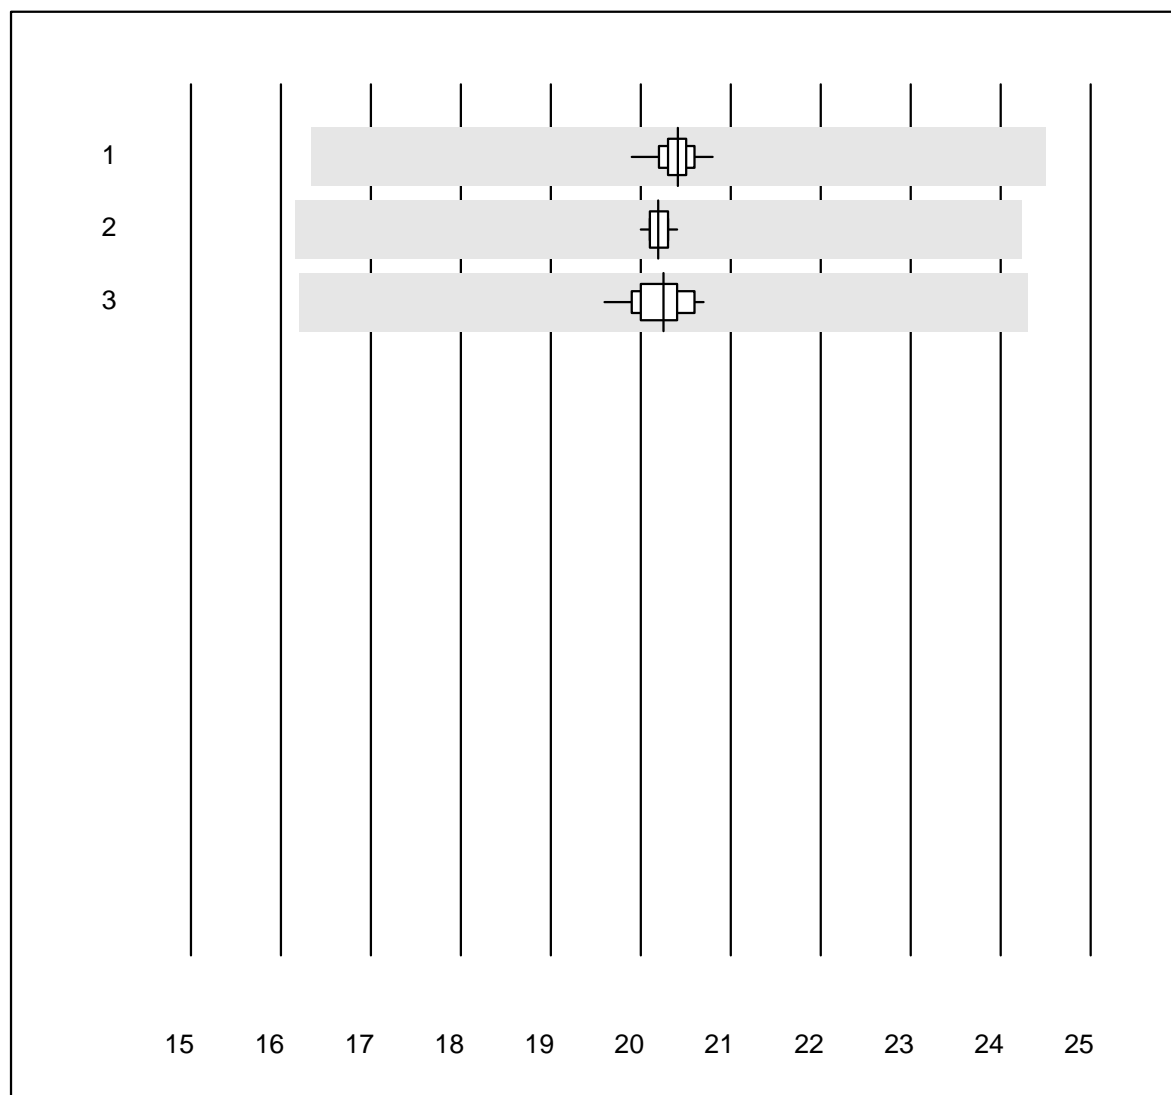


Tolérance QUALAB : 20 %

FCOHb OR (%)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ABL700/800	51	100.0	0.0	0.0	20.416	0.9	e
2 ABL 90	31	100.0	0.0	0.0	20.197	0.5	e
3 ABL 80 / Coox	17	100.0	0.0	0.0	20.253	1.4	e

FMetHb OR

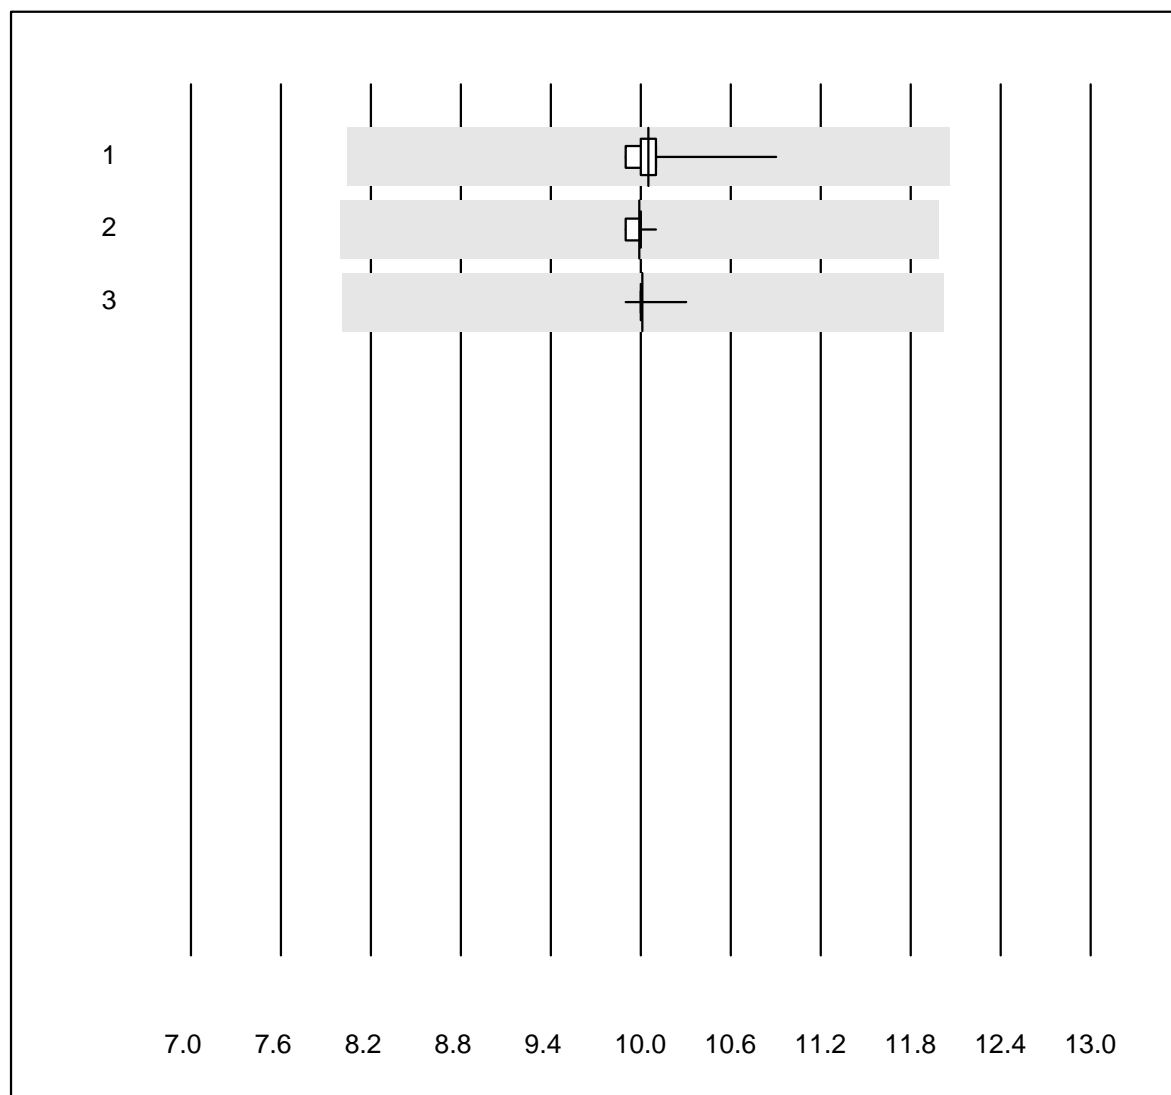


Tolérance QUALAB : 20 %

FMetHb OR (%)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ABL700/800	54	100.0	0.0	0.0	10.052	1.5	e
2 ABL 90	31	100.0	0.0	0.0	9.990	0.4	e
3 ABL 80 / Coox	17	94.1	0.0	5.9	10.013	0.8	e

FHbF OR

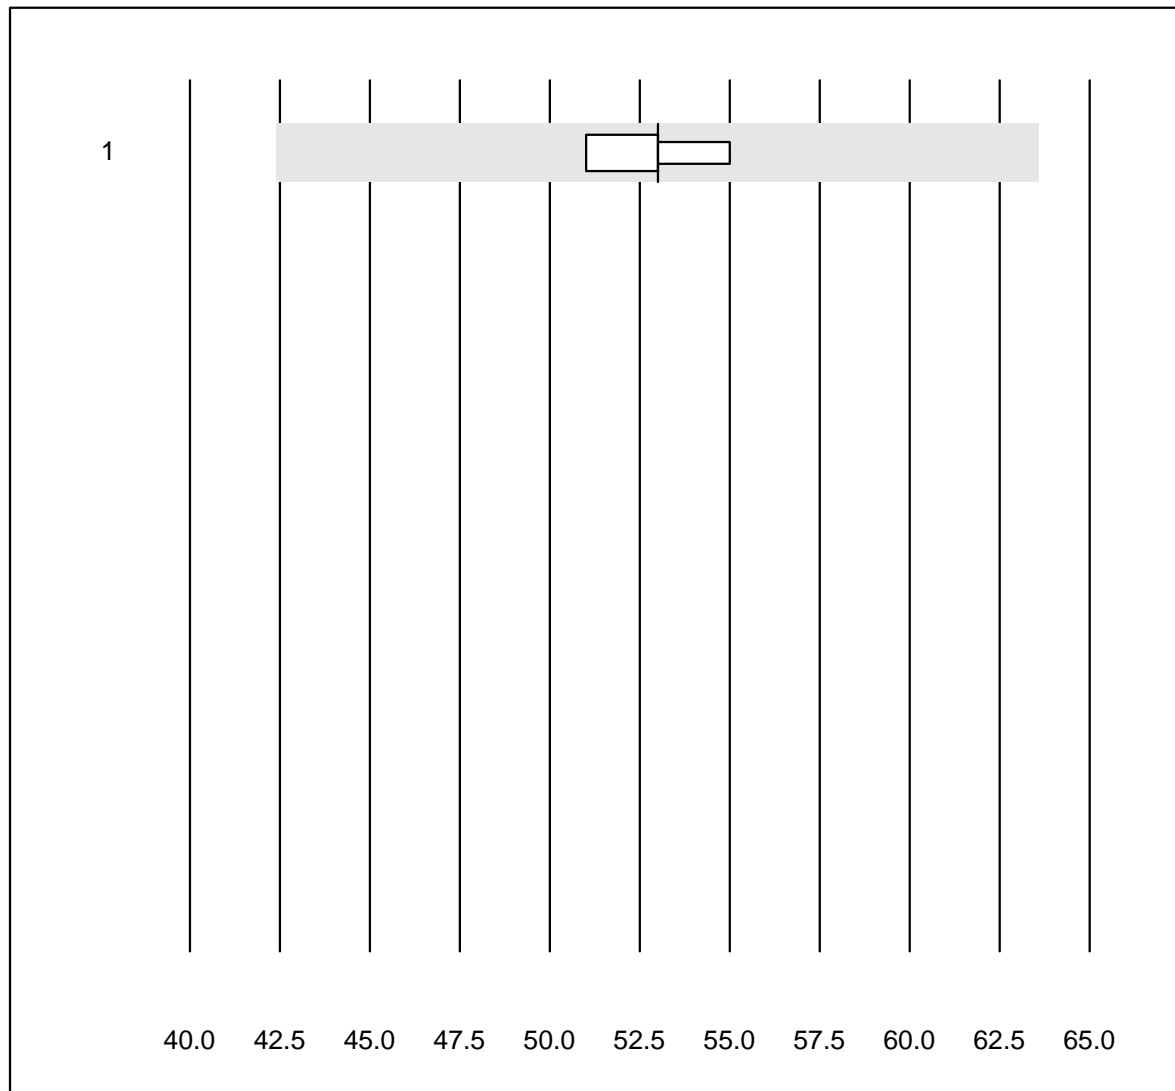


Tolérance QUALAB : 20 %

FHbF OR (%)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ABL 90	8	100.0	0.0	0.0	53.000	2.5	e

Bilirubin OR

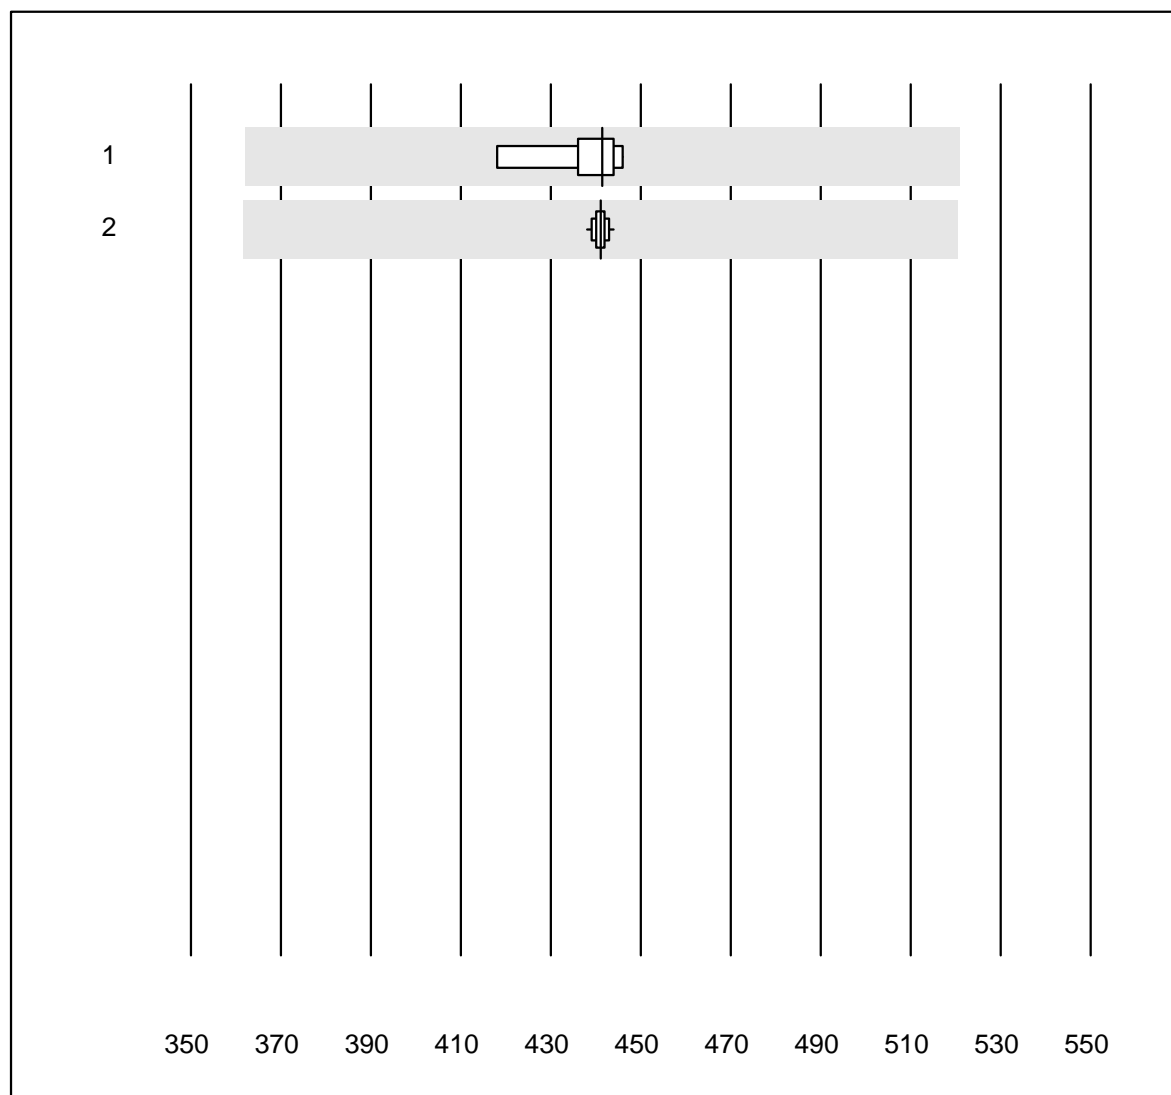


Tolérance QUALAB : 18 %

Bilirubin OR (µmol/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ABL700/800	6	100.0	0.0	0.0	441.5	2.4	e
2 ABL 90	15	100.0	0.0	0.0	441.1	0.3	e

Troponine I

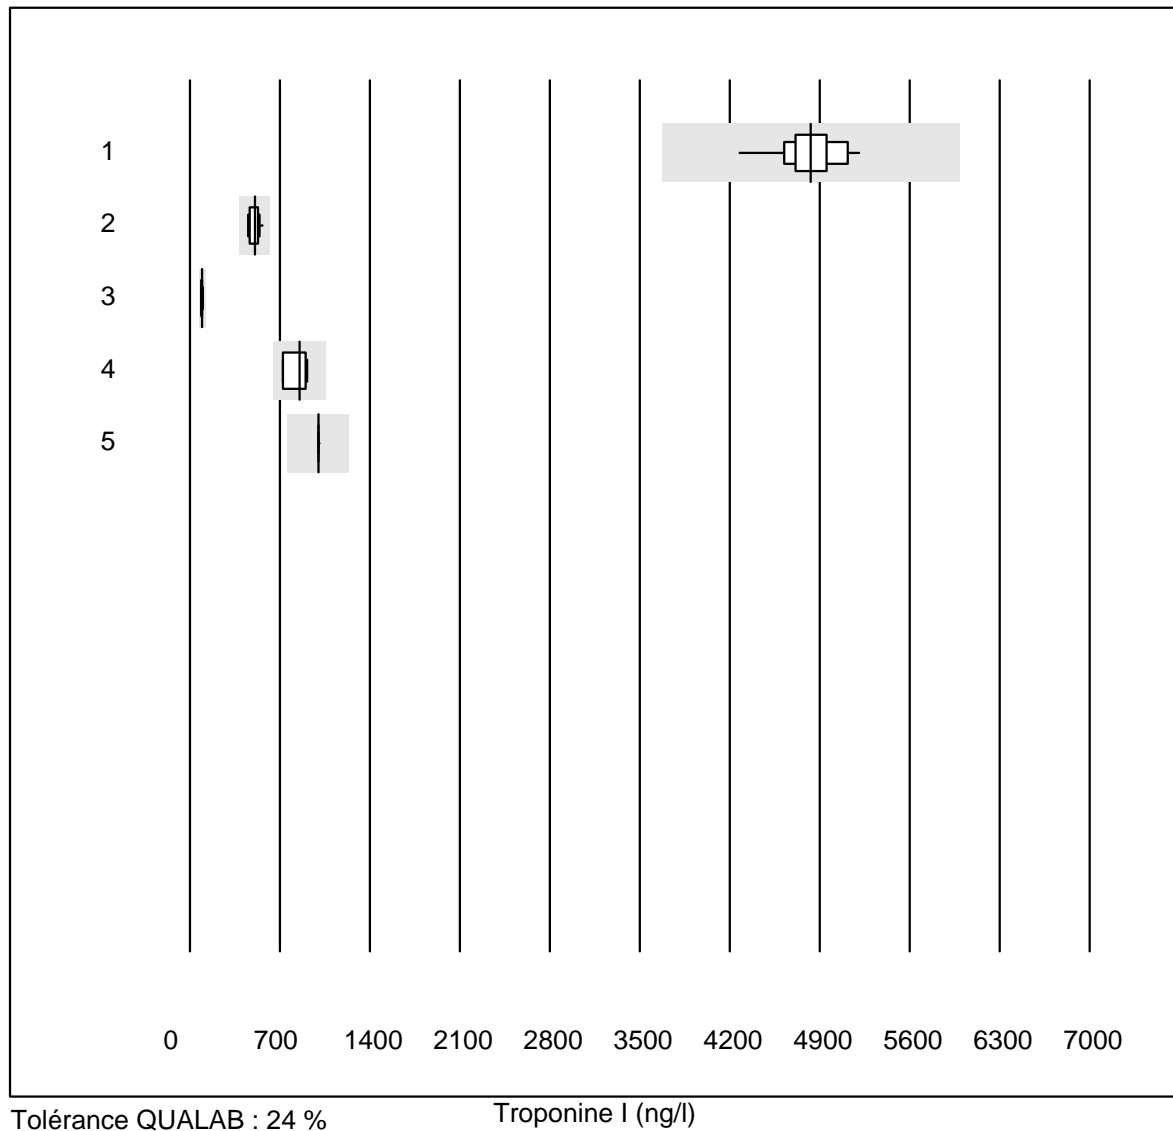

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Vidas	12	100.0	0.0	0.0	4830.0	5.2	e
2	Architect High Sensi	10	100.0	0.0	0.0	503.5	7.4	e
3	AQT 90 FLEX	6	100.0	0.0	0.0	93.0	4.5	e
4	ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	855.5	10.3	e*
5	Eurolyser	18	94.4	0.0	5.6	1000.0	0.0	e

Troponine T

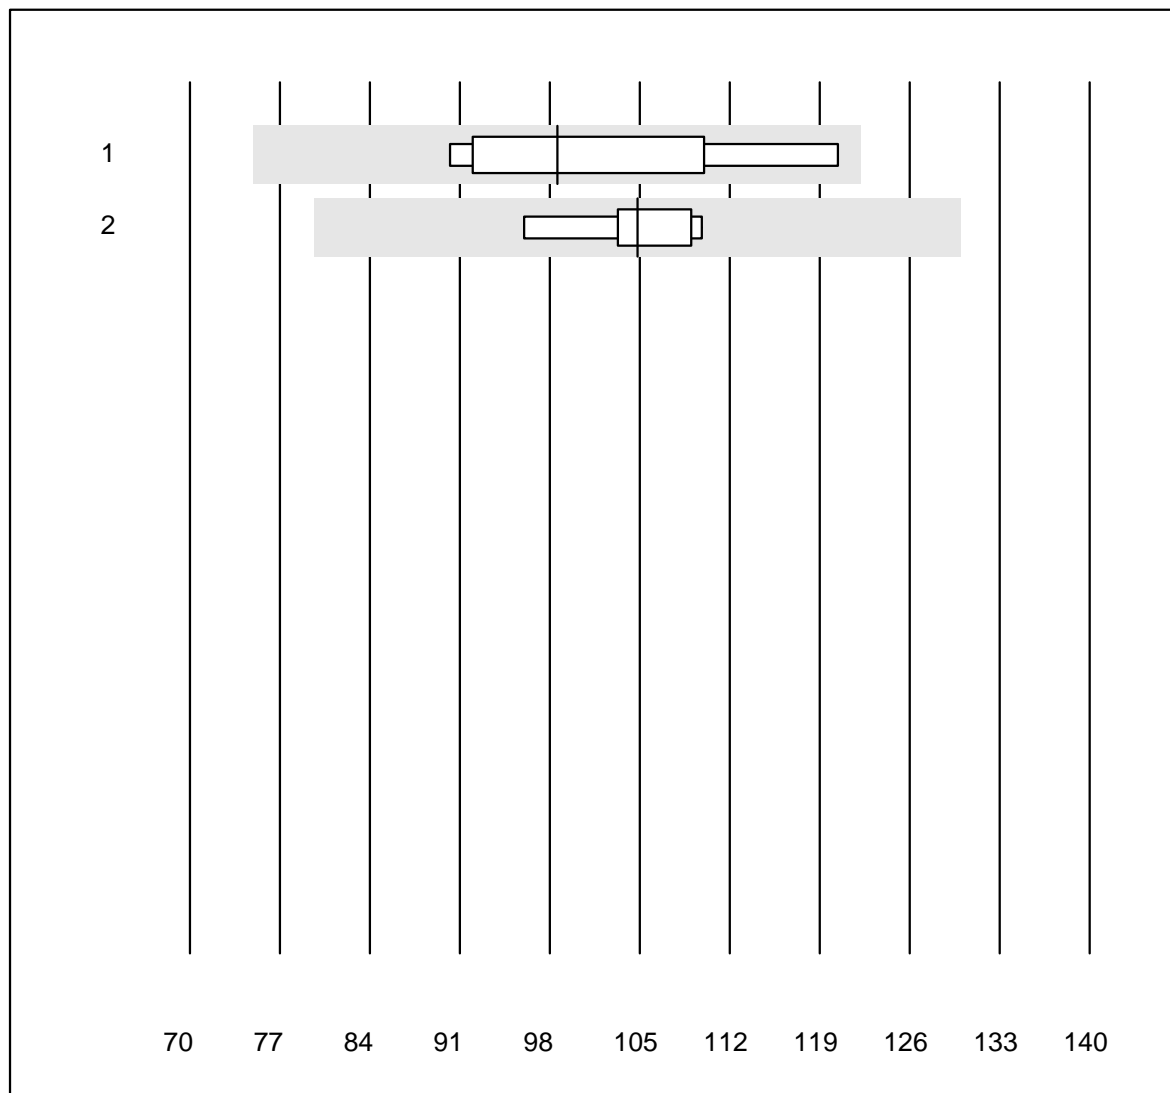


Tolérance QUALAB : 24 %

Troponine T (ng/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas hs	5	100.0	0.0	0.0	98.60	12.5	e*
2	Cobas hs STAT	6	100.0	0.0	0.0	104.85	4.7	e

Myoglobine

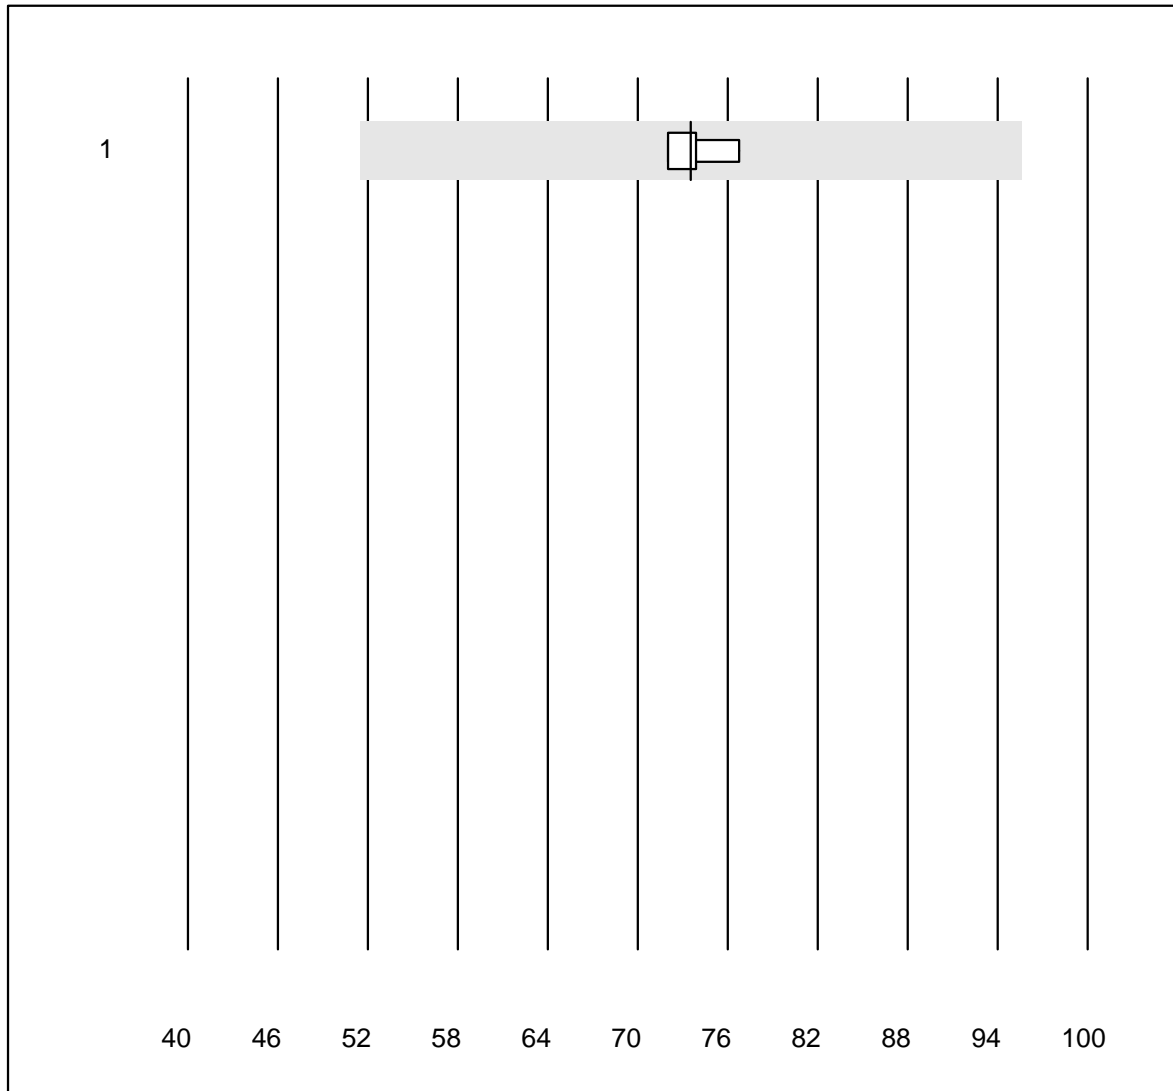


Tolérance QUALAB : 30 %

Myoglobine (µg/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	4	100.0	0.0	0.0	73.5	2.7	e

masse CK-MB

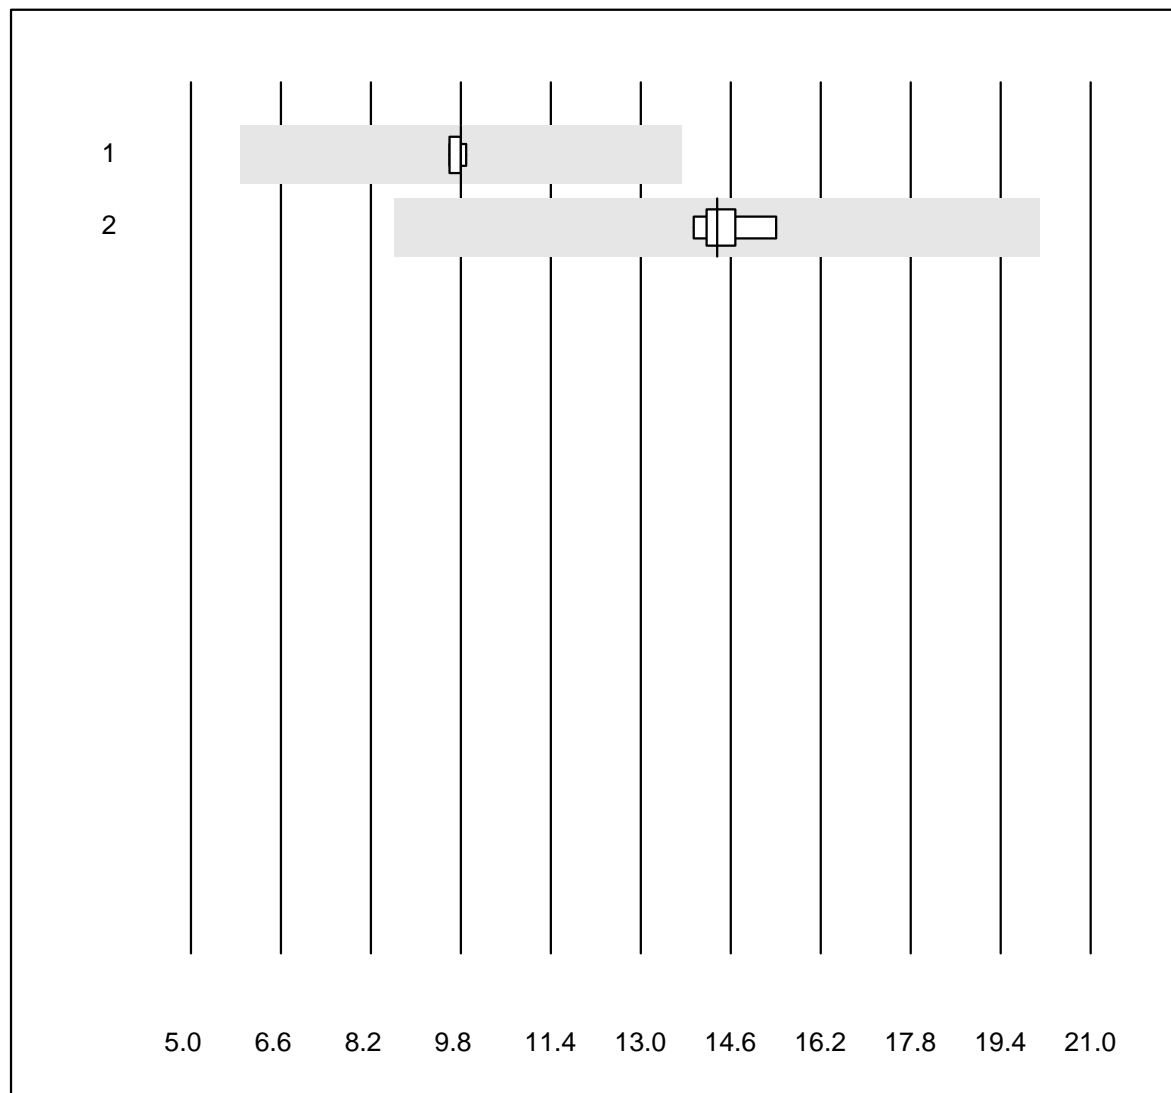


Tolérance QUALAB : 40 %

masse CK-MB (µg/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Architect	4	100.0	0.0	0.0	9.8	1.3	e
2 VIDAS	6	100.0	0.0	0.0	14.4	3.5	e

TSH

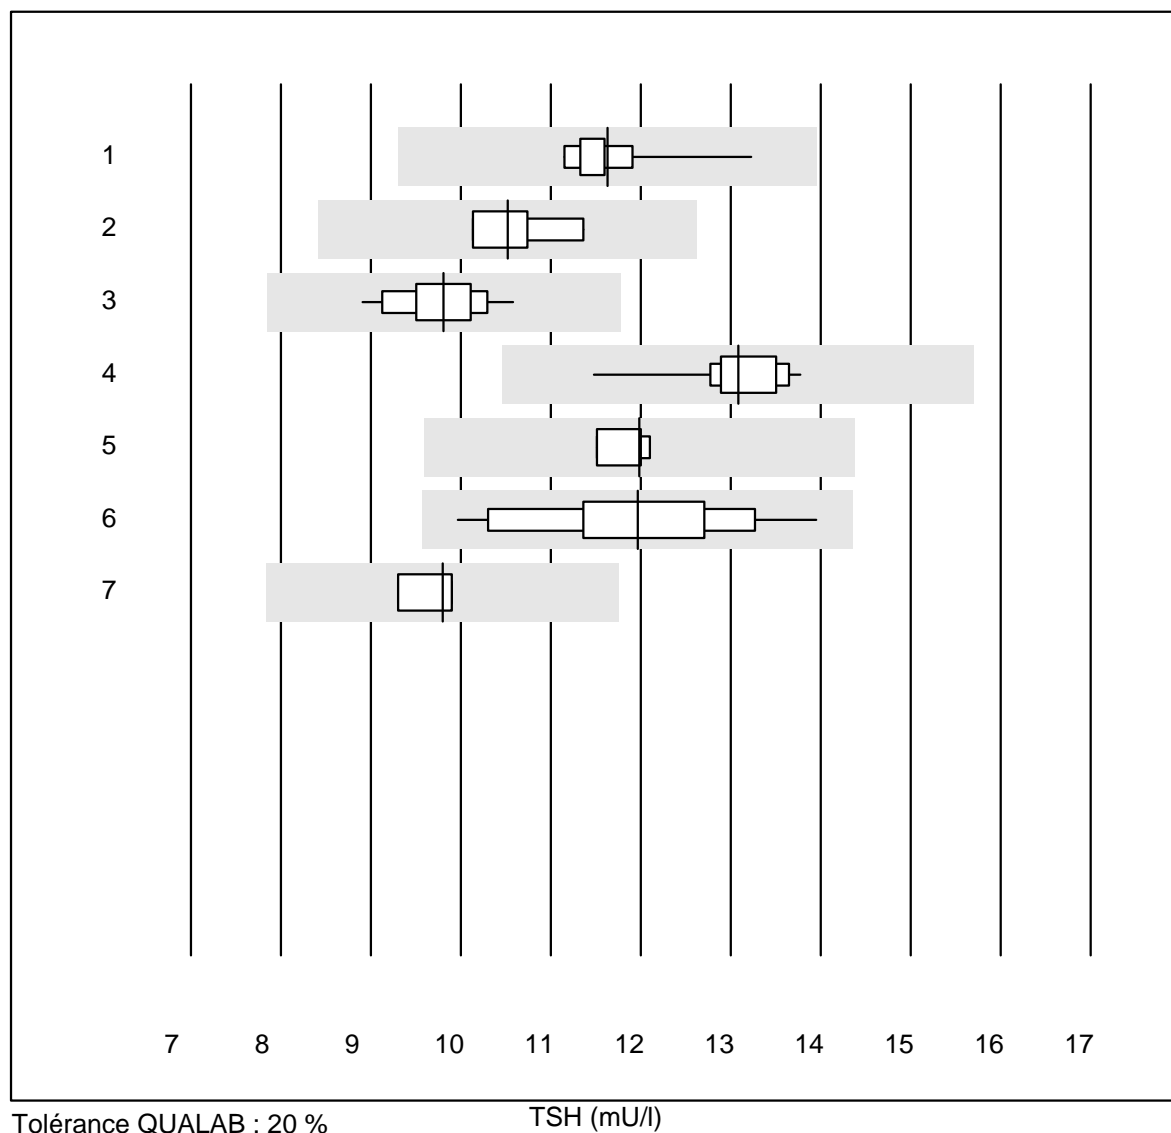


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	10	100.0	0.0	0.0	11.63	5.2	e
2	ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	10.52	5.2	e*
3	Architect	13	100.0	0.0	0.0	9.81	4.7	e
4	VIDAS	15	100.0	0.0	0.0	13.08	4.1	e
5	Dimension	4	100.0	0.0	0.0	11.99	2.2	e
6	AFIAS	19	100.0	0.0	0.0	11.96	8.6	e
7	Qualigen	4	100.0	0.0	0.0	9.80	2.9	e

T3

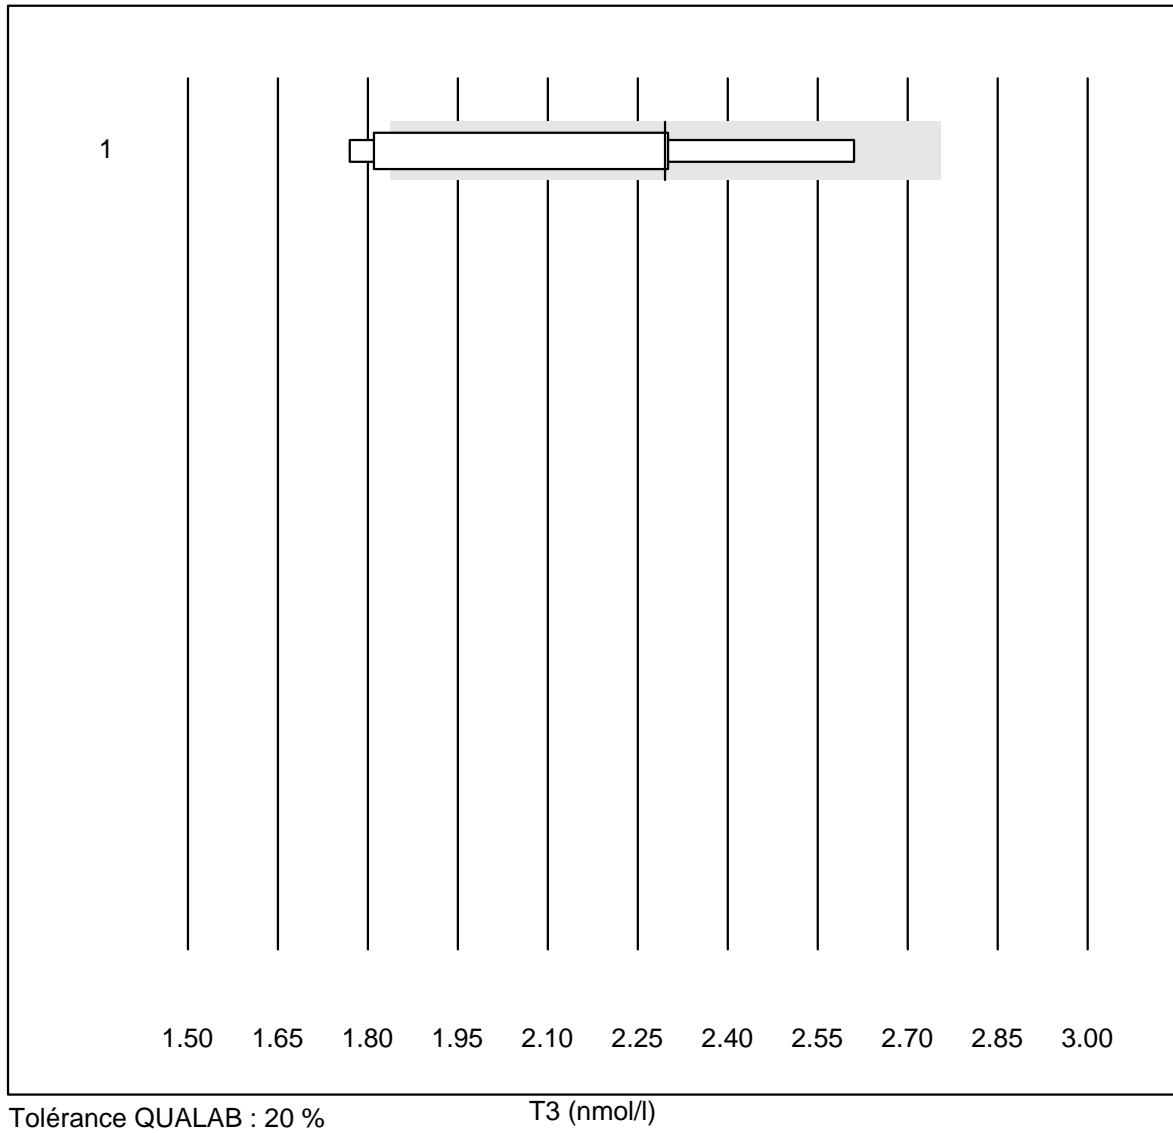

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 AFIAS	8	75.0	25.0	0.0	2.3	13.3	e*

T4

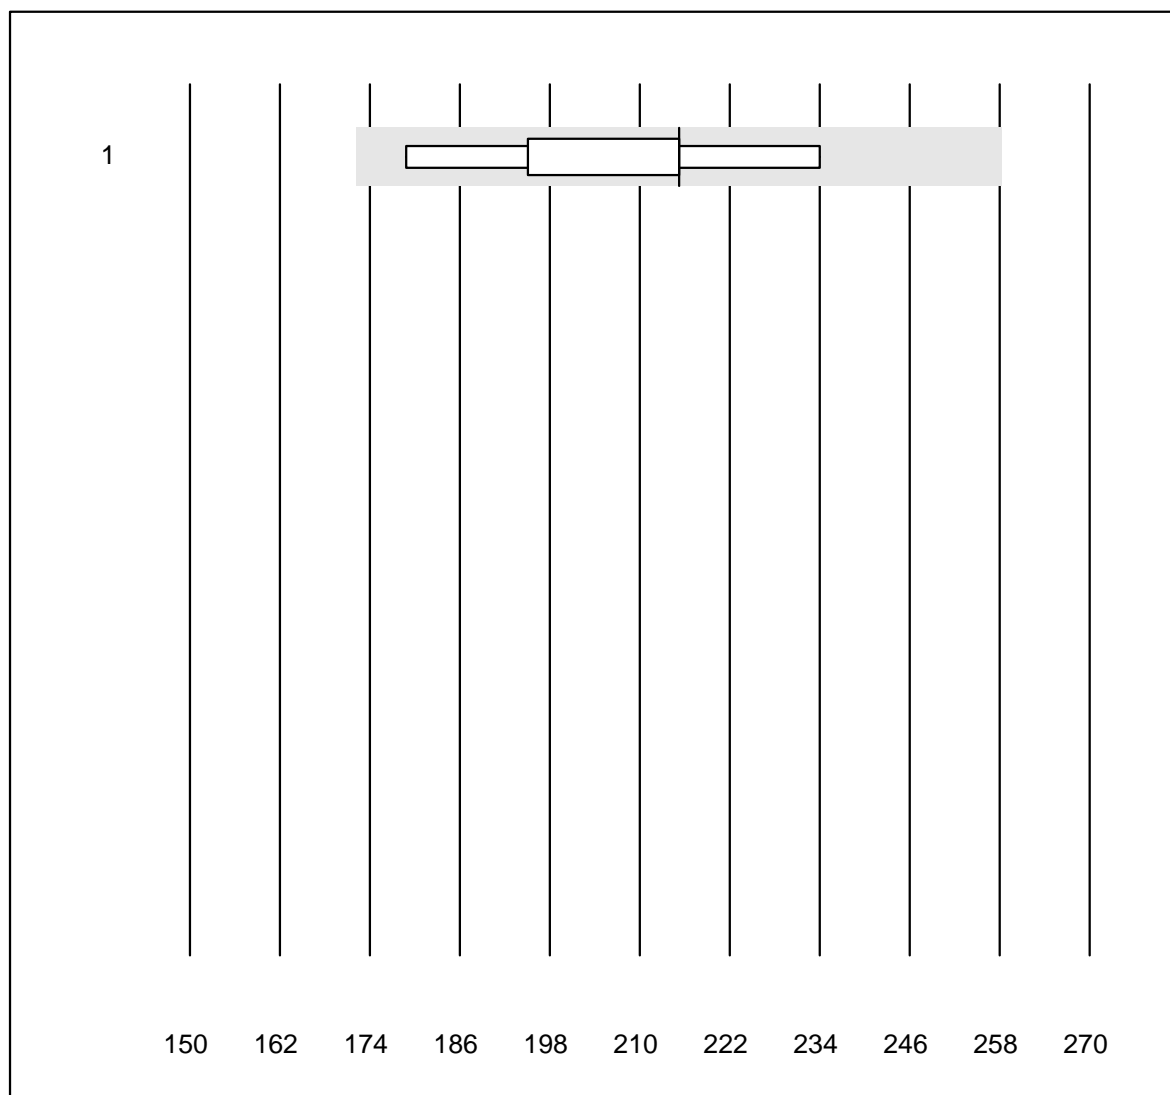


Tolérance QUALAB : 20 %

T4 (nmol/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 AFIAS	9	66.7	0.0	33.3	215	9.3	e*

FT3

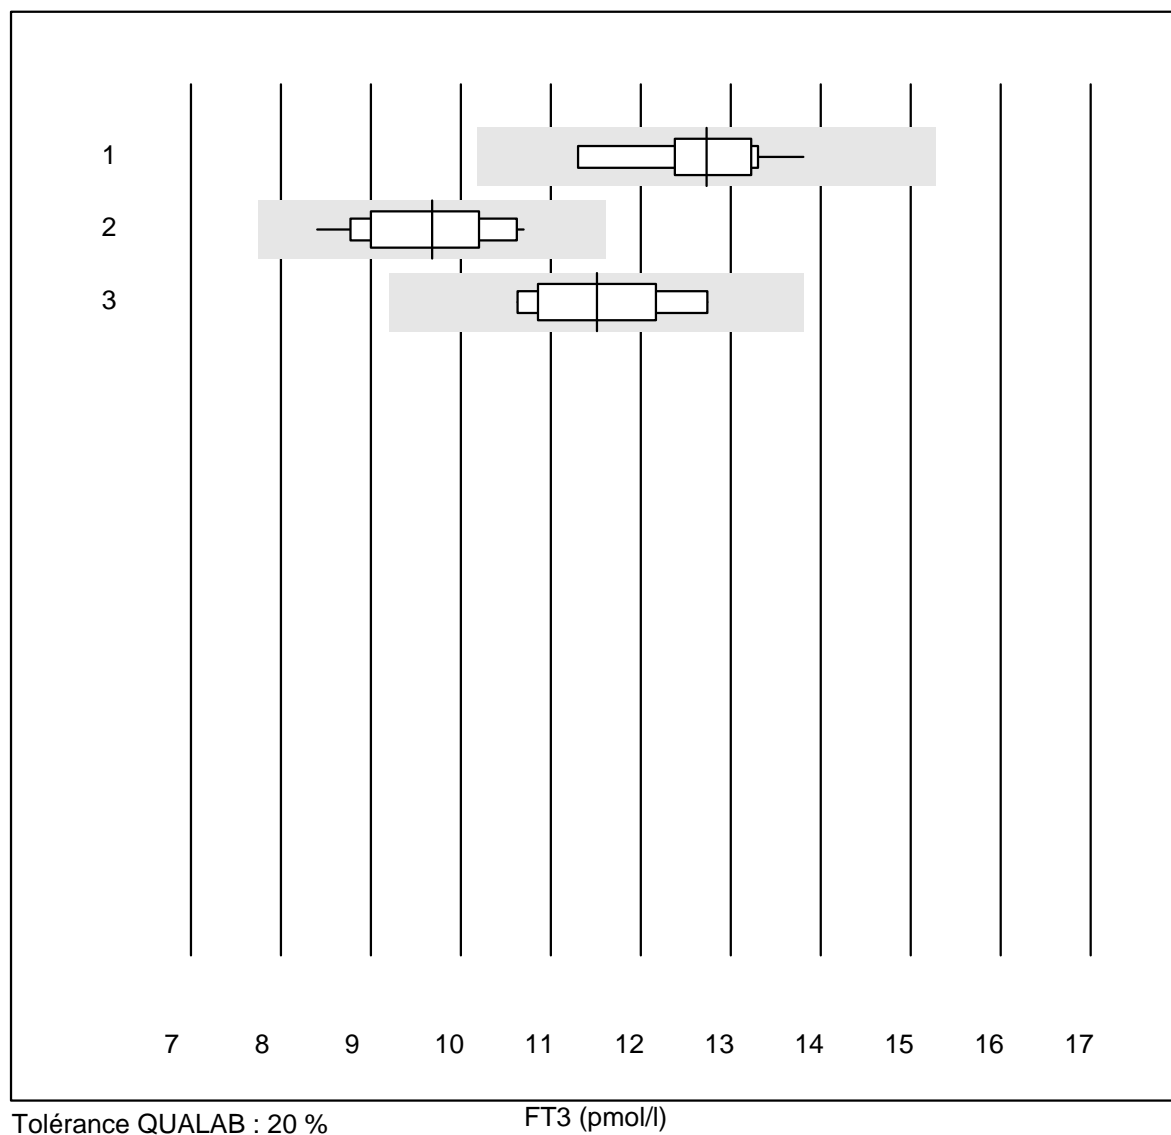


Tolérance QUALAB : 20 %

FT3 (pmol/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	10	100.0	0.0	0.0	12.7	5.6	e
2 Architect	12	100.0	0.0	0.0	9.7	7.7	e
3 VIDAS	7	100.0	0.0	0.0	11.5	6.2	e

FT4

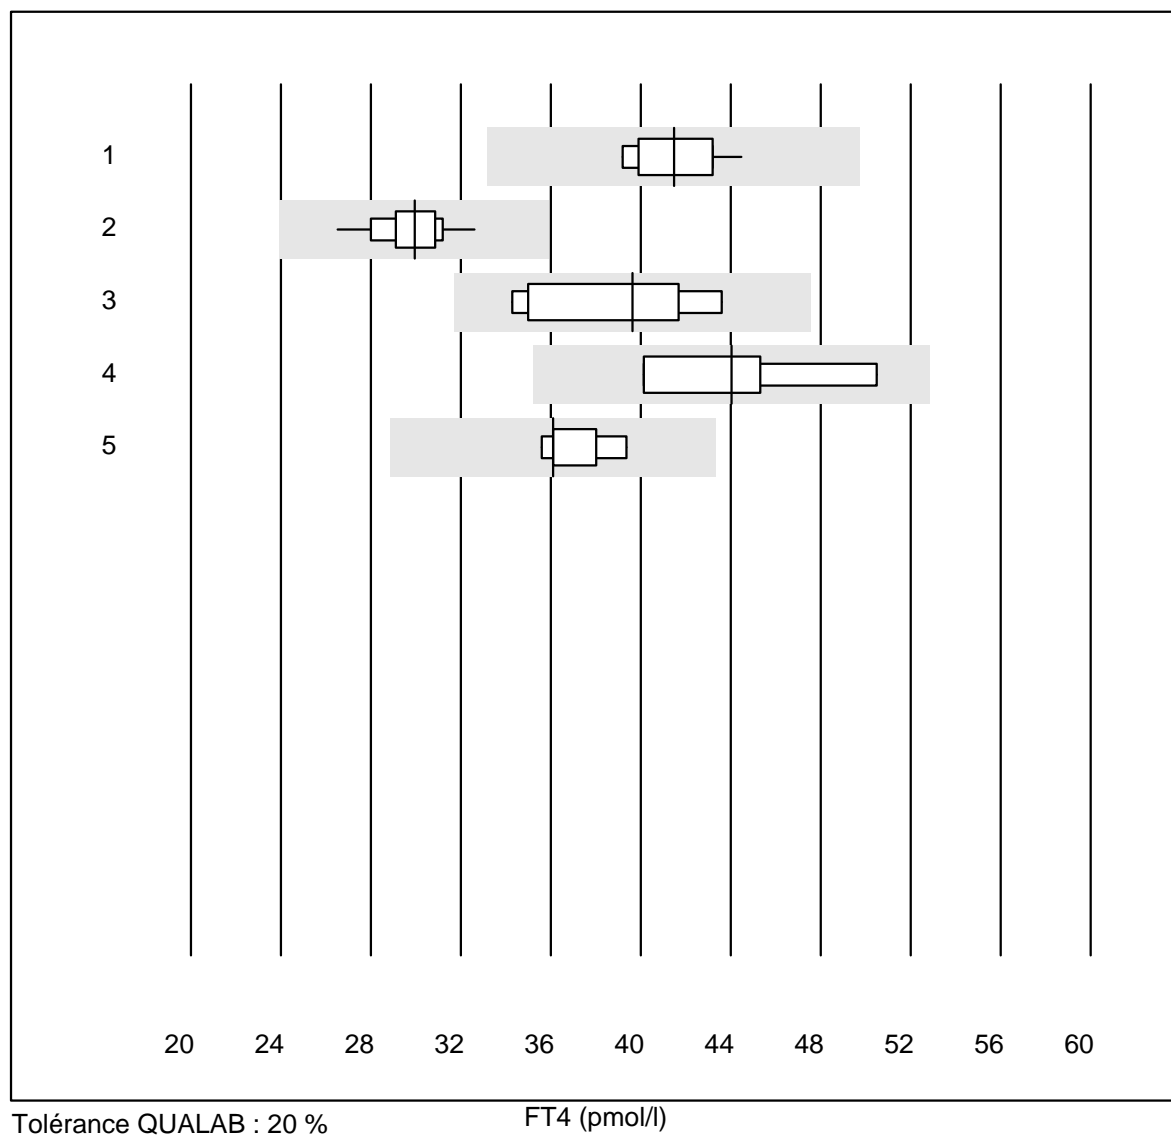

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	10	100.0	0.0	0.0	41.5	4.3	e
2 Architect	13	100.0	0.0	0.0	29.9	5.1	e
3 VIDAS	7	100.0	0.0	0.0	39.6	9.1	e*
4 Qualigen	4	100.0	0.0	0.0	44.0	9.9	e*
5 Autres méthodes	5	100.0	0.0	0.0	36.1	4.3	e

Testostérone

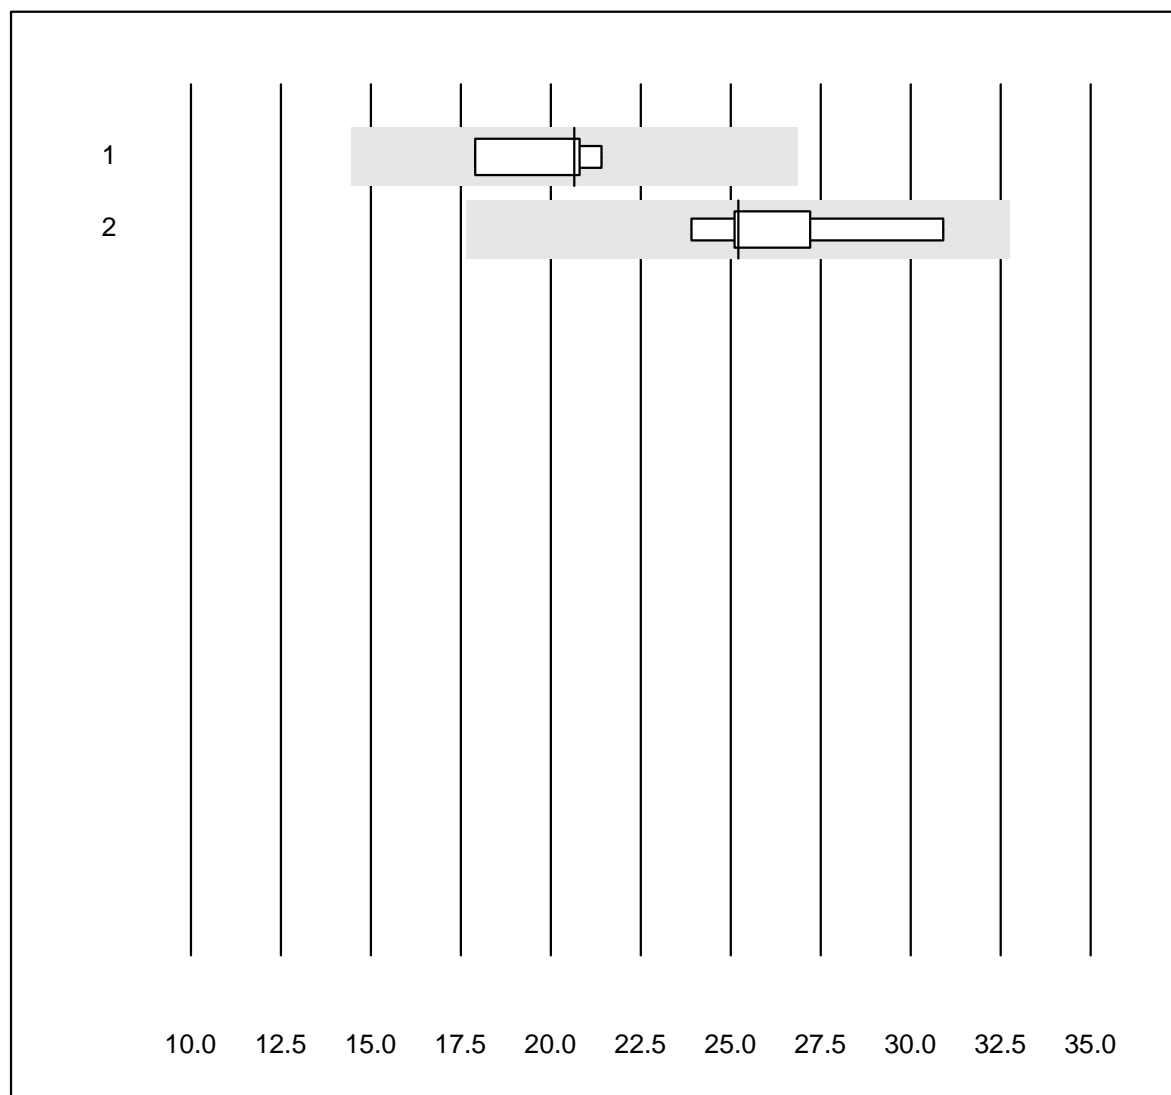


Tolérance QUALAB : 30 %

Testostérone (nmol/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	21	7.7	e*
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	25	10.4	e*

Estradiol

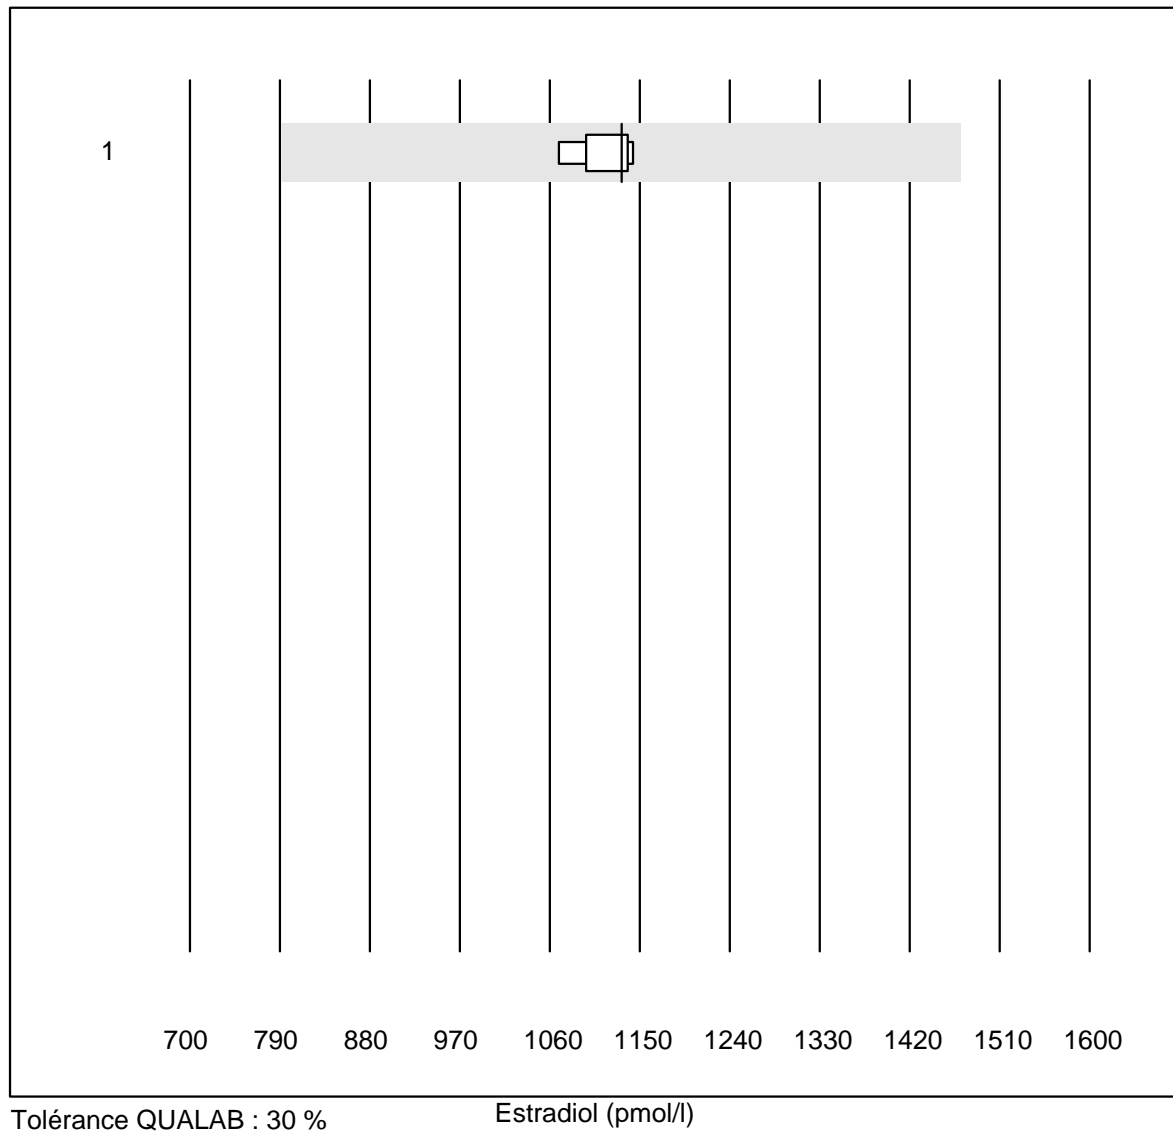

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Architect	5	100.0	0.0	0.0	1132	2.9	e

Cortisol

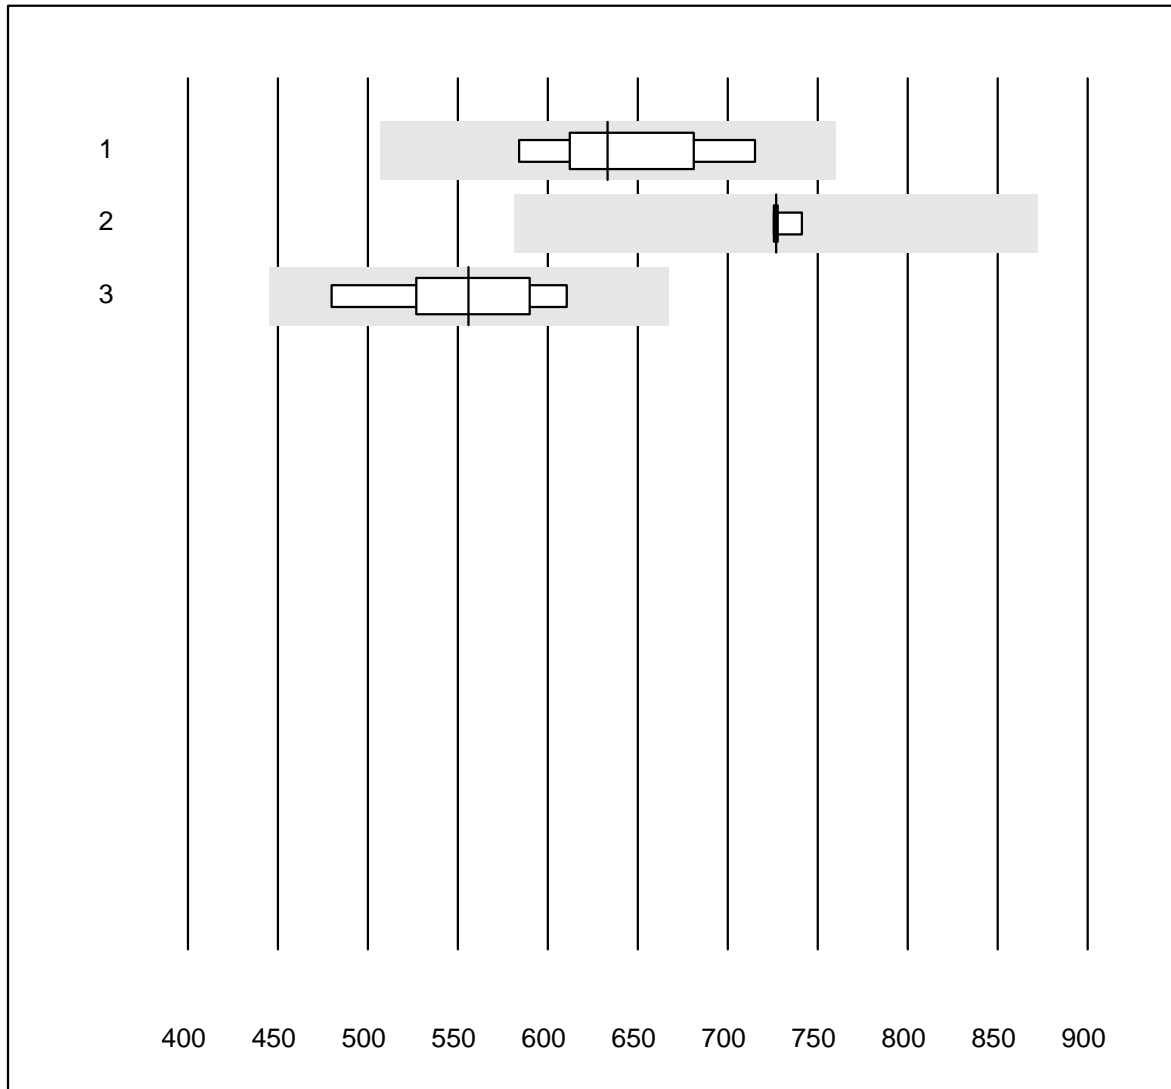


Tolérance QUALAB : 20 %

Cortisol (nmol/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	7	100.0	0.0	0.0	633	6.8	e*
2 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	727	1.0	e
3 Architect	6	100.0	0.0	0.0	556	8.5	e*

Luteinisierendes Hormon

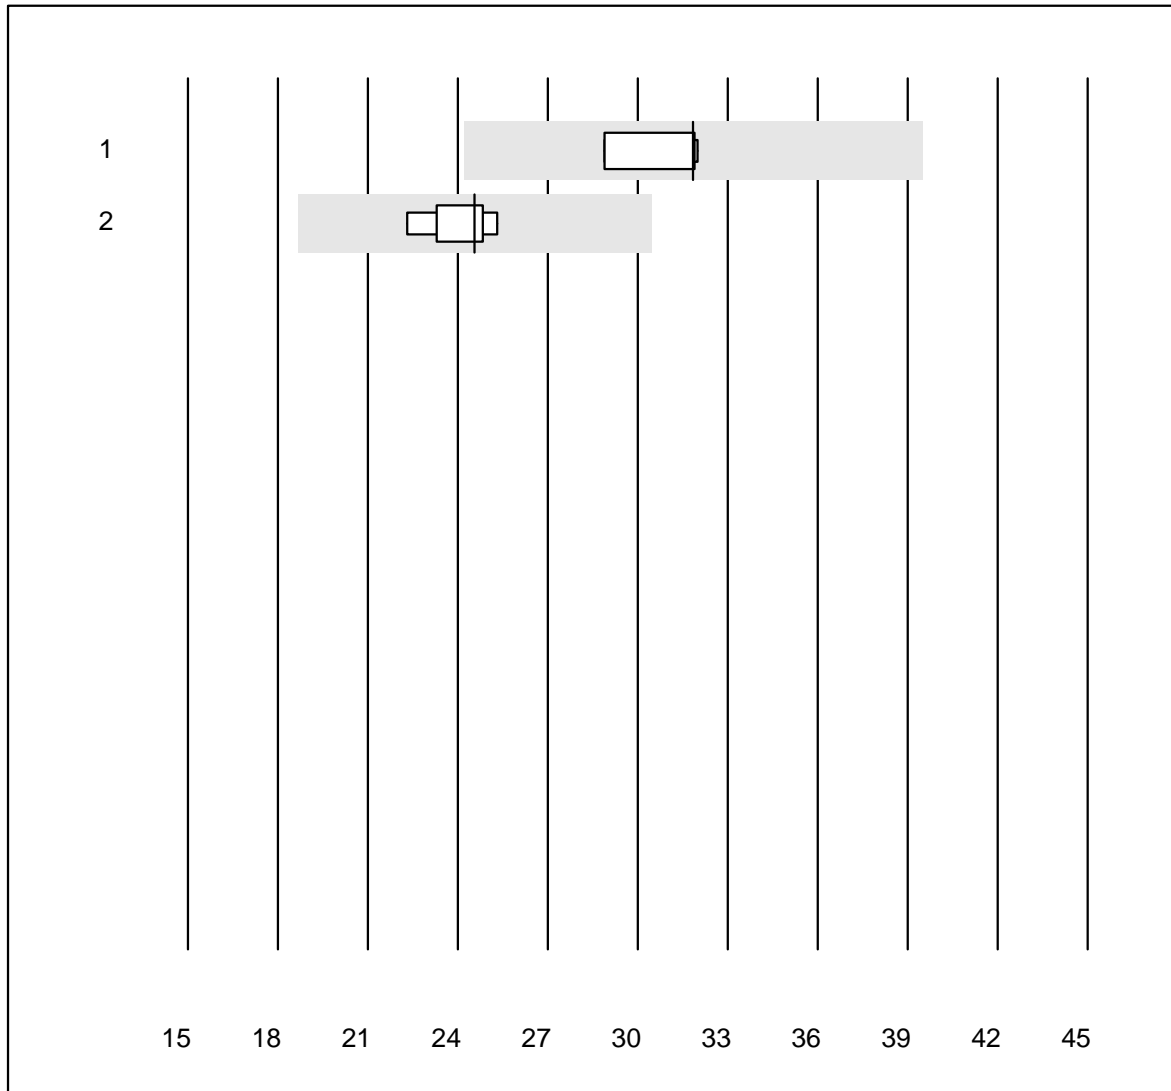


Tolérance QUALAB : 24 %

Luteinisierendes Hormon (U/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	31.9	4.8	e
2	Architect	6	100.0	0.0	0.0	24.6	4.7	e


Follikelstimulierendes Hormon

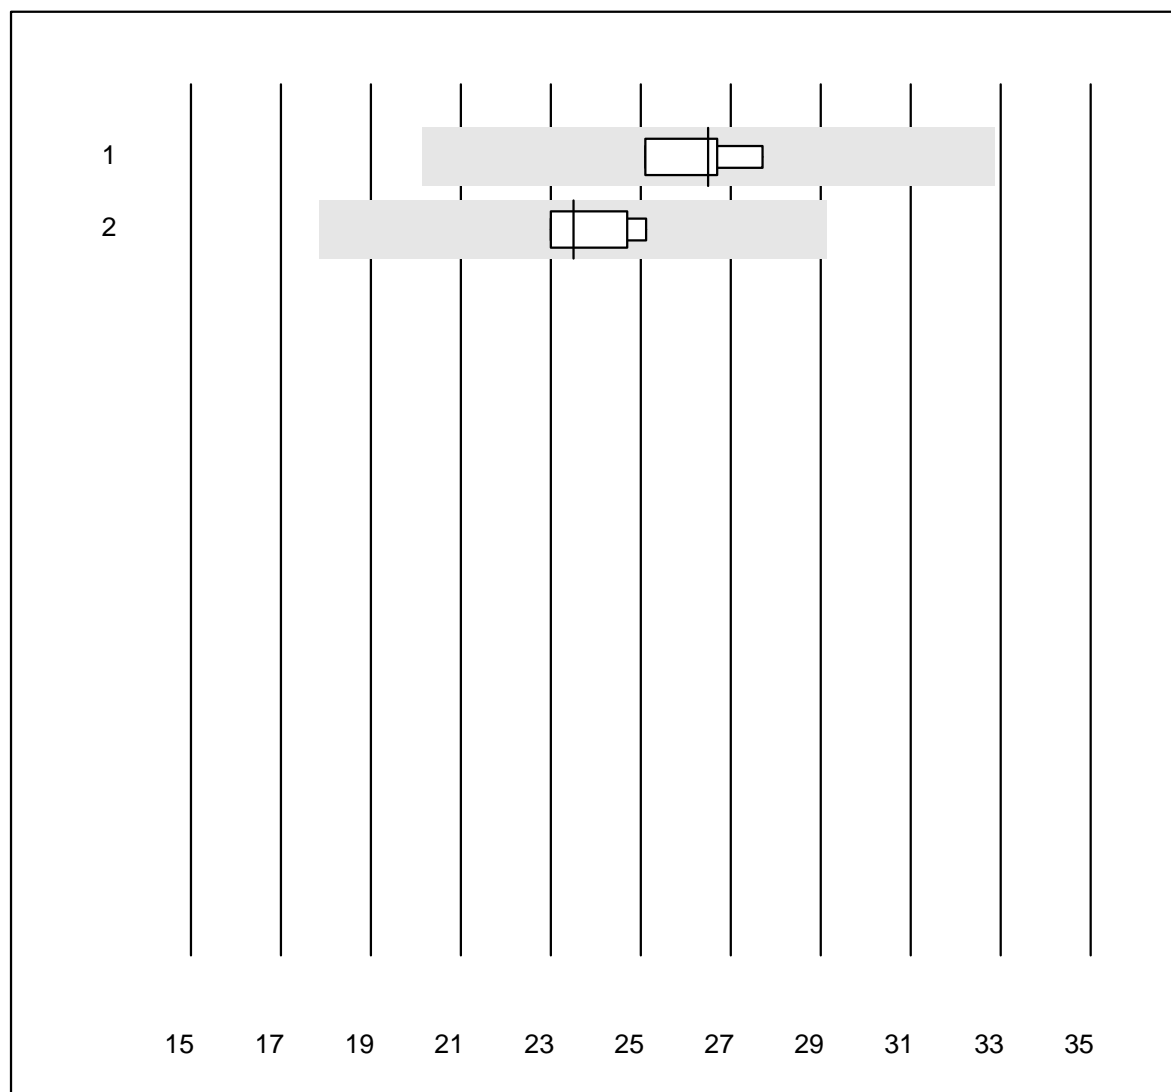

Tolérance QUALAB : 24 % Follikelstimulierendes Hormon (U/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	26.5	4.1	e
2	Architect	6	100.0	0.0	0.0	23.5	3.8	e

Prolaktin (PRL)

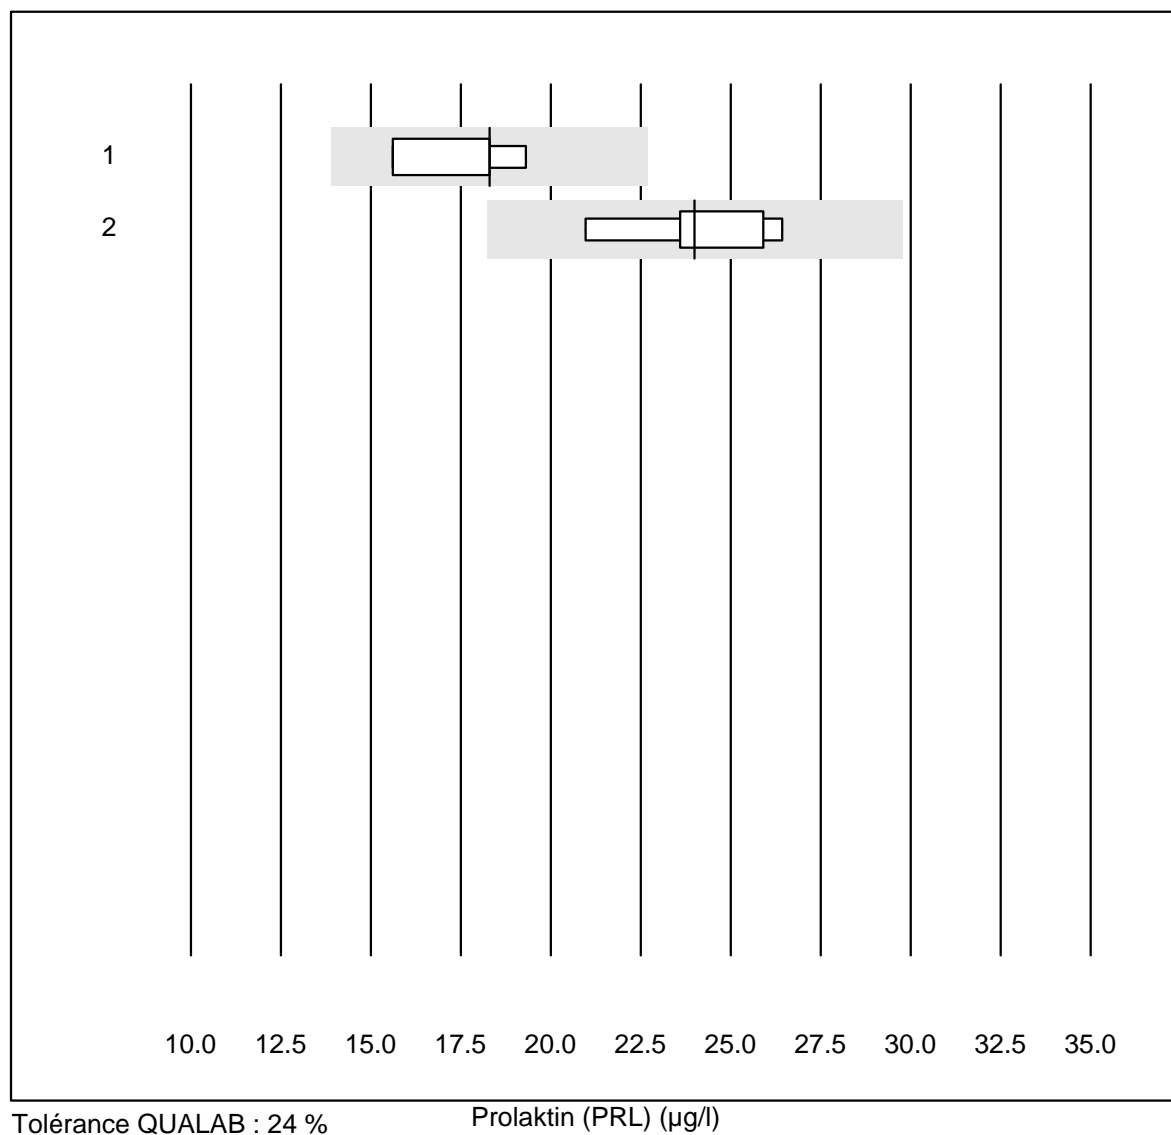

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	18.3	8.9	e*
2	Architect	6	100.0	0.0	0.0	24.0	8.0	e*

Troponine T CR

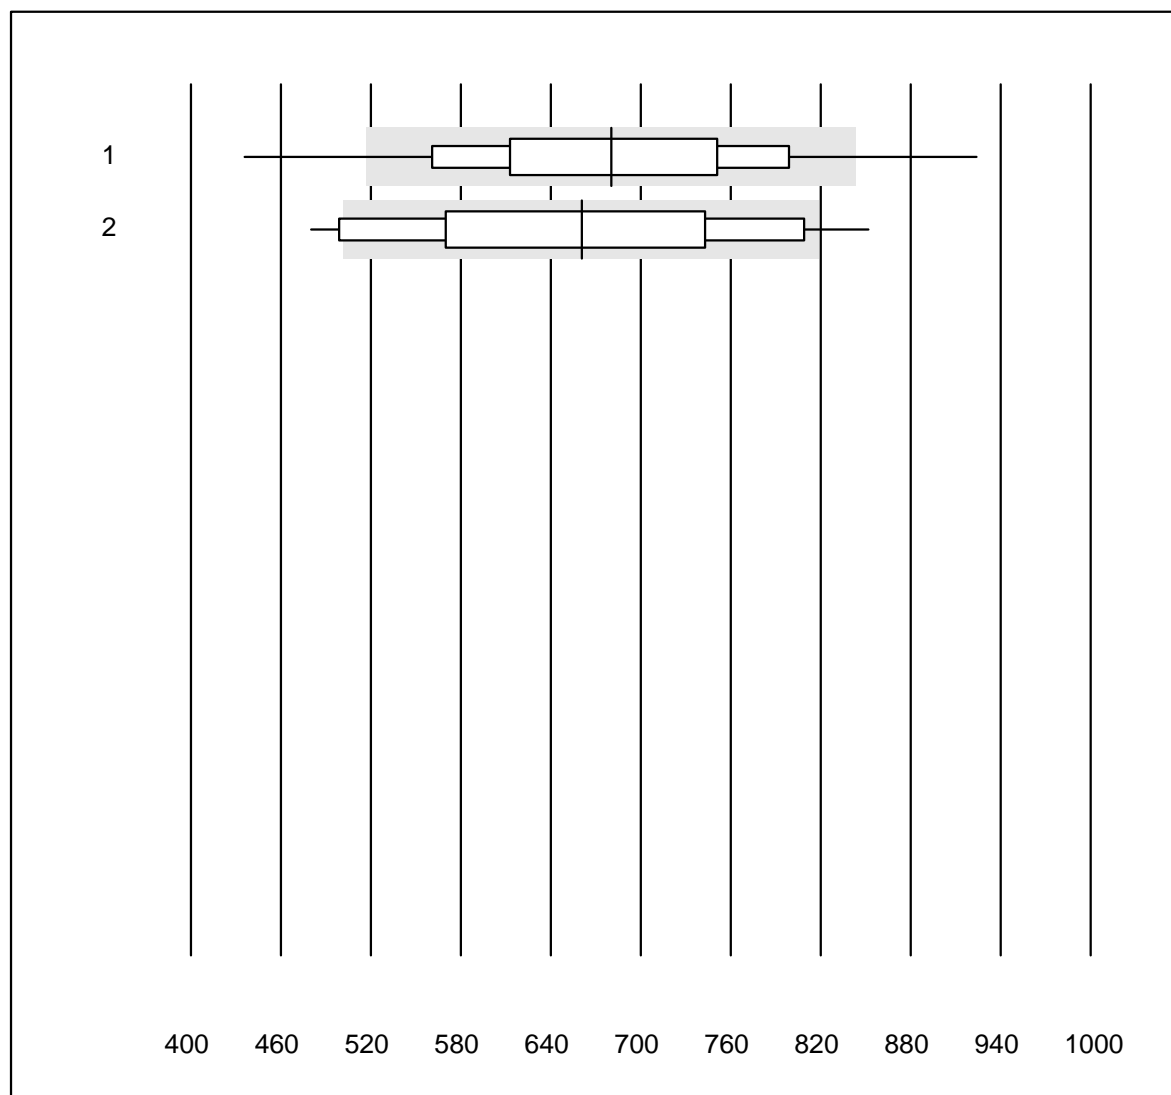


Tolérance QUALAB : 24 %

Troponine T CR (ng/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas h 232	981	90.0	6.6	3.4	680.12	13.6	e
2	Cardiac Reader	23	78.3	21.7	0.0	660.61	17.3	e*

D-Dimères CR

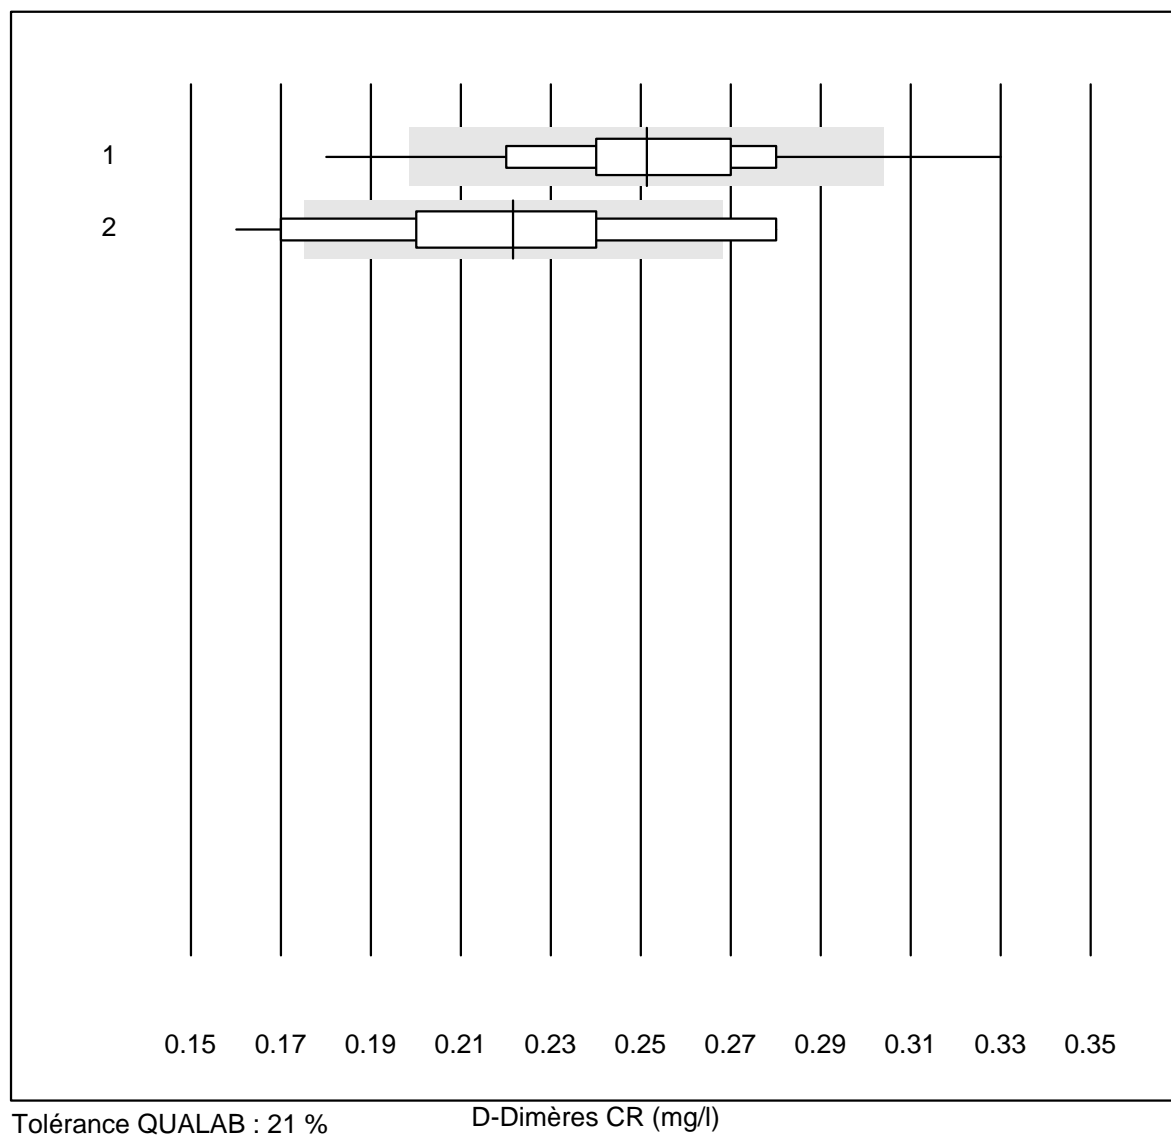


Tolérance QUALAB : 21 %

D-Dimères CR (mg/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas h 232	995	94.6	3.2	2.2	0.25	10.2	e
2 Cardiac Reader	20	70.0	25.0	5.0	0.22	15.4	e*

CKMB - K8

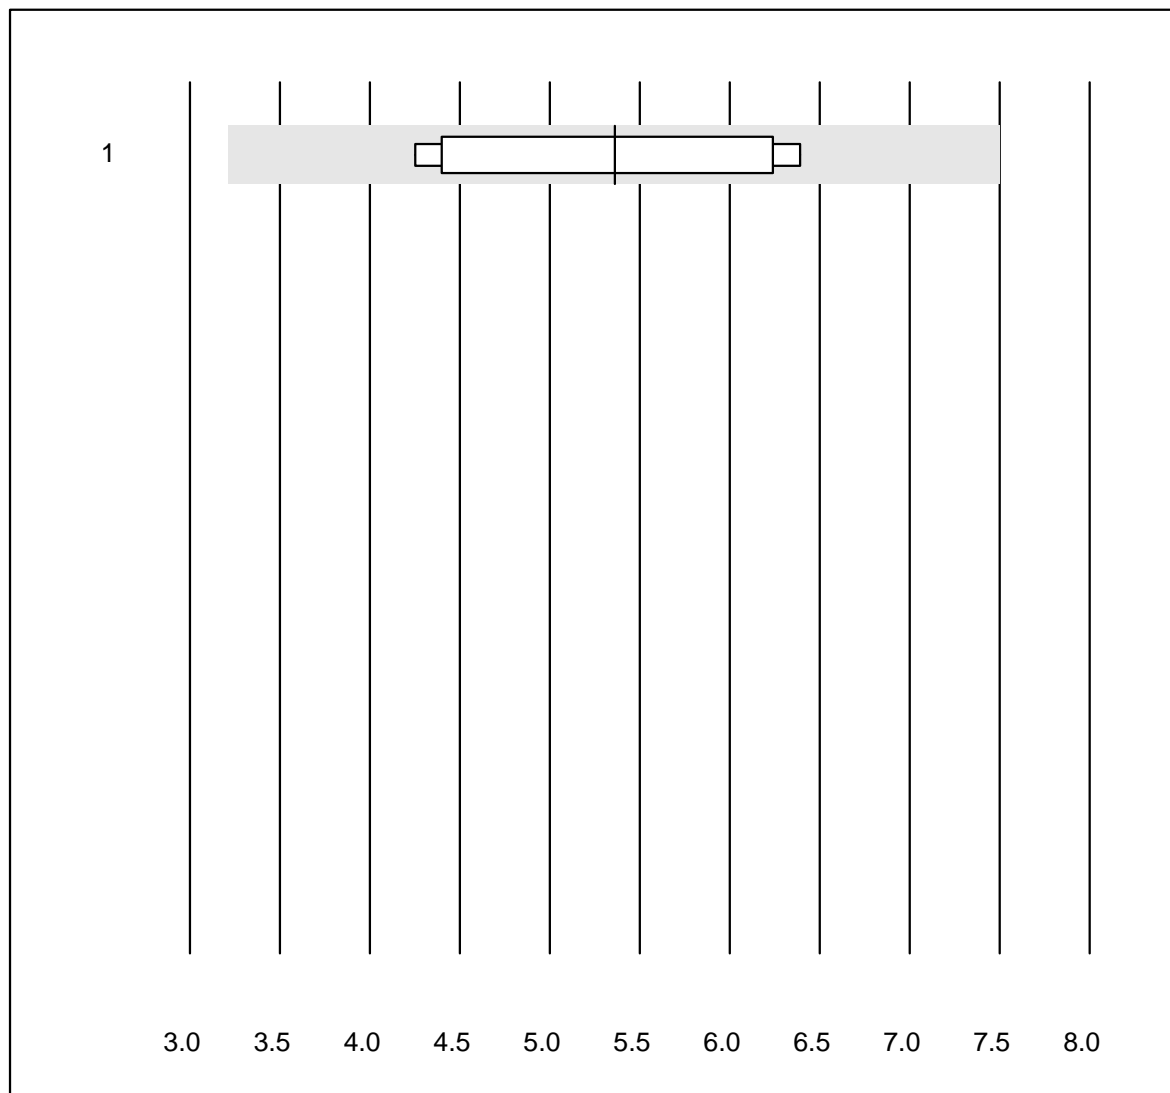


Tolérance QUALAB : 40 %

CKMB - K8 (µg/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas h 232	8	100.0	0.0	0.0	5.4	16.9	e*

proBNP CR

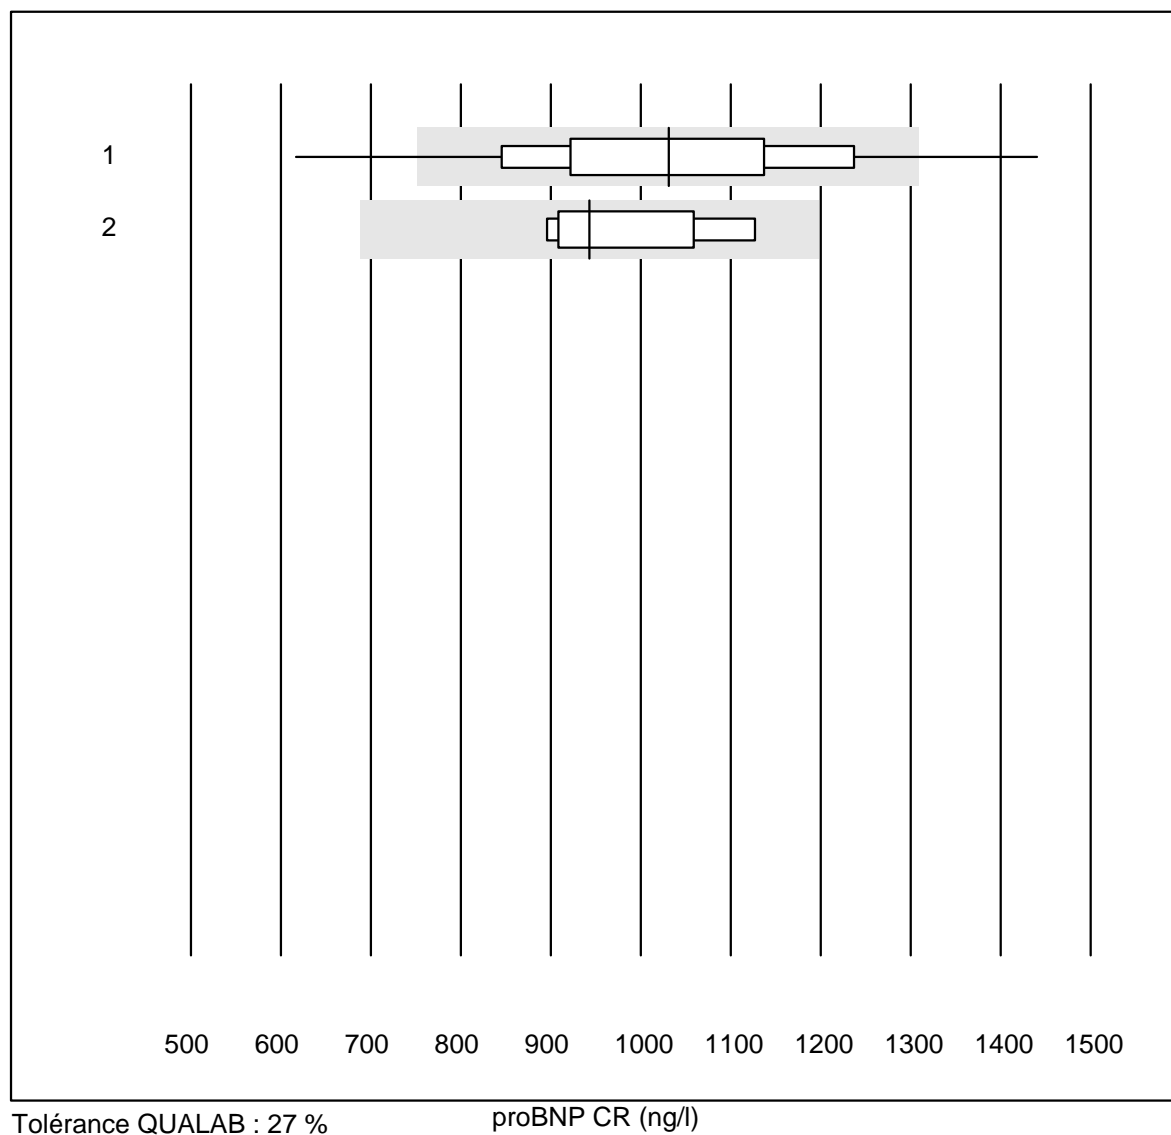

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas h 232	610	92.3	6.2	1.5	1031	14.8	e
2	Cardiac Reader	5	100.0	0.0	0.0	943	10.3	e*

PCO2 CCA

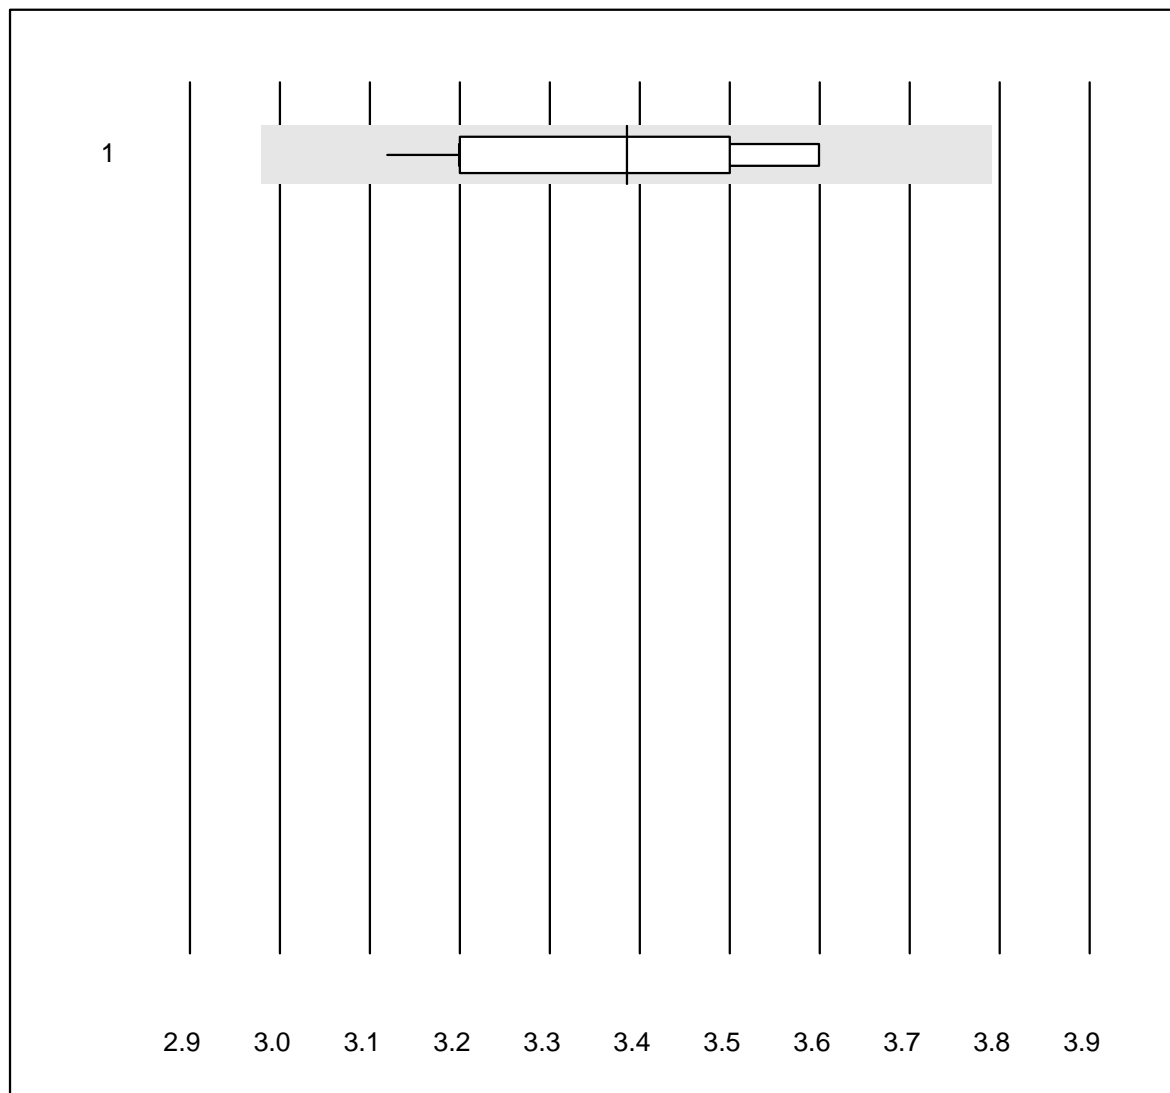


Tolérance QUALAB : 12 %

PCO2 CCA (kPa)

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 OPTI CCA	12	100.0	0.0	0.0	3.39	5.0	e

PO2 CCA

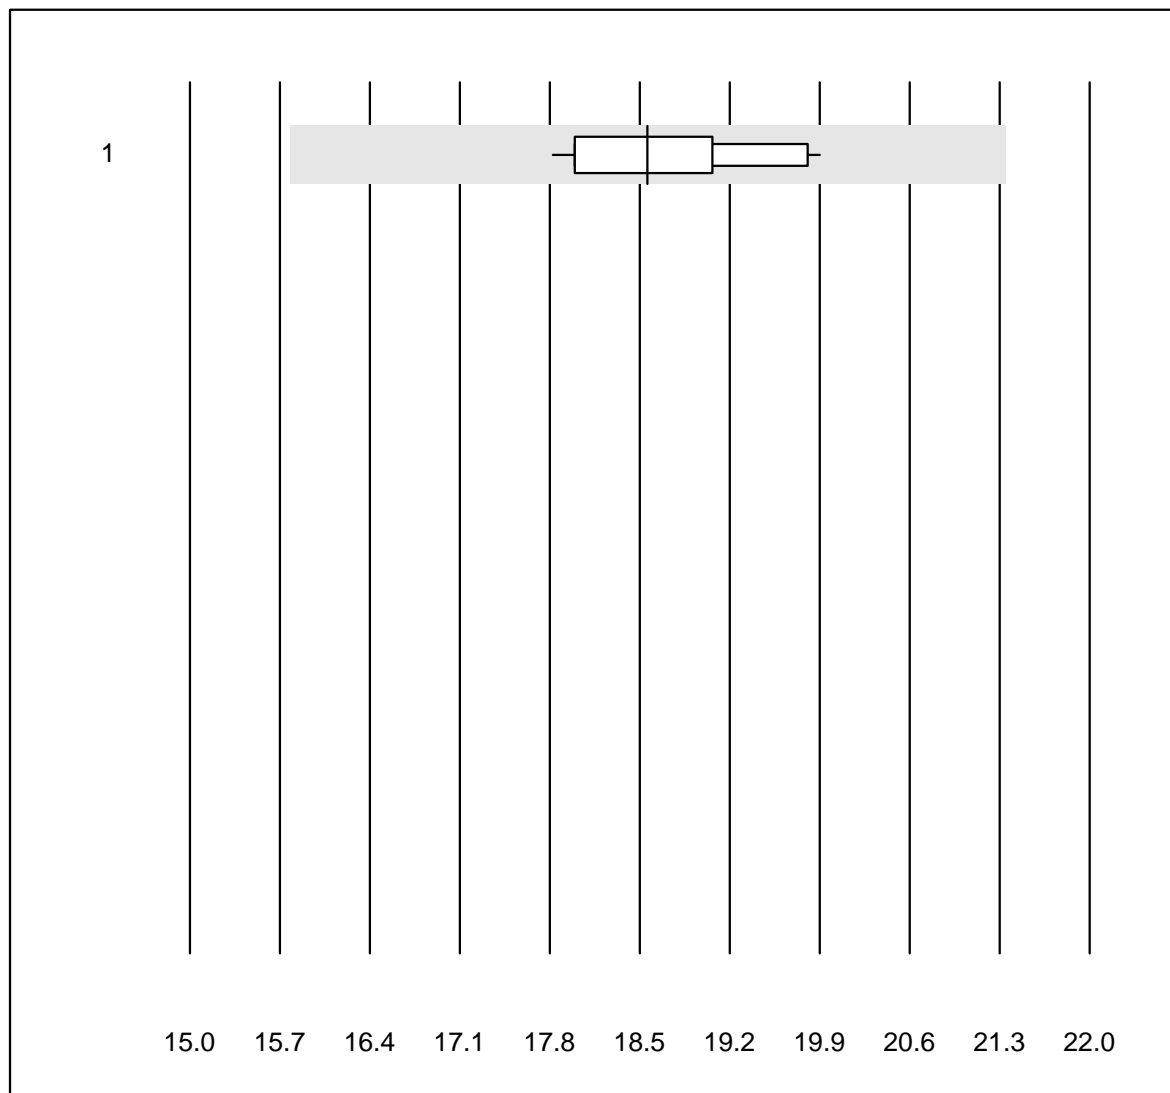


Tolérance QUALAB : 15 %

PO2 CCA (kPa)

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 OPTI CCA	12	91.7	0.0	8.3	18.56	3.9	e

pH CCA

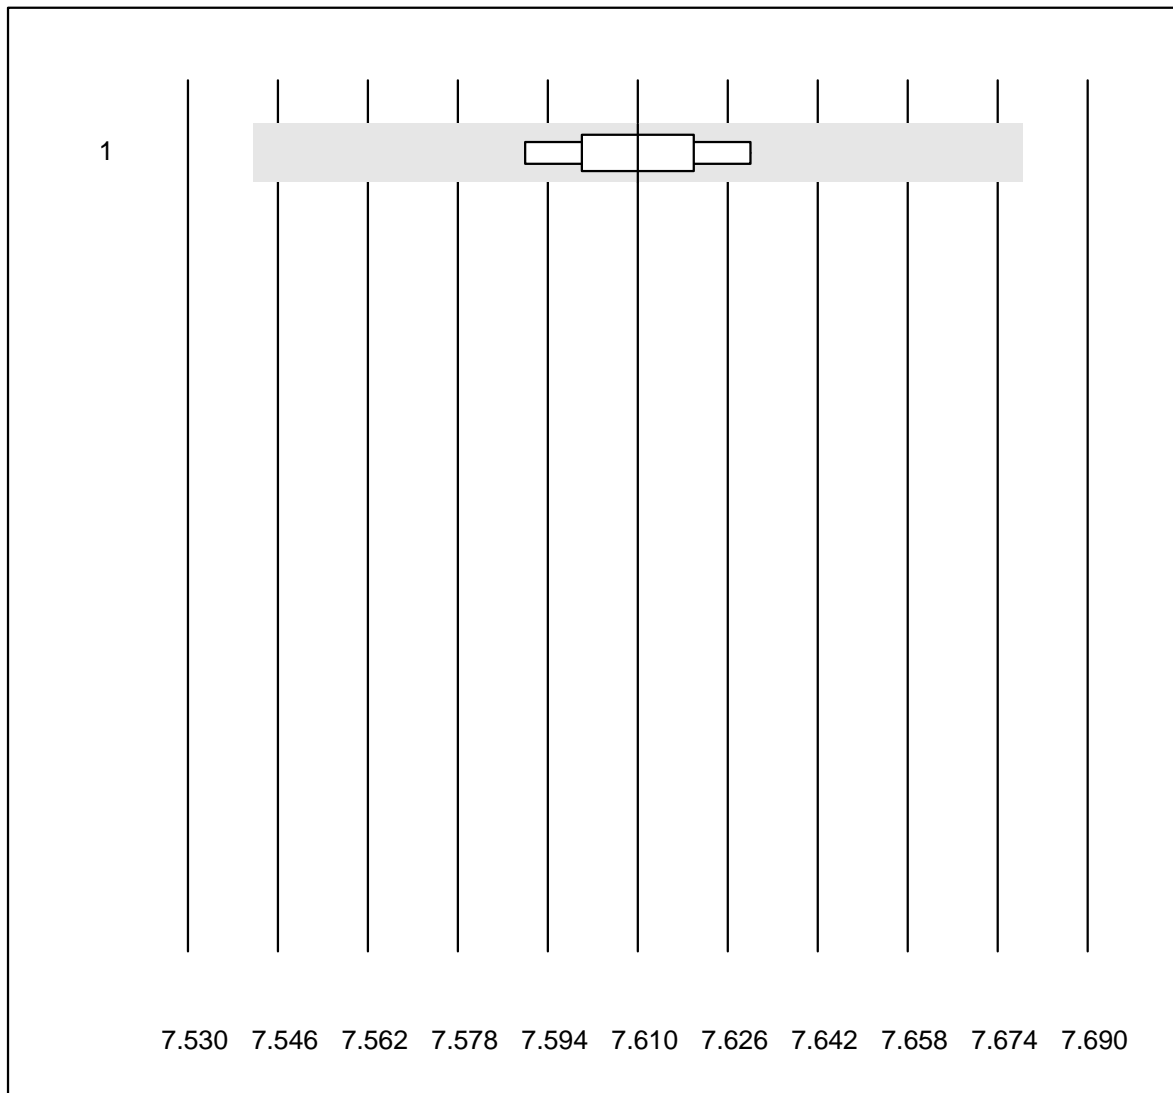


Tolérance QUALAB : 1 %

pH CCA ()

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 OPTI CCA	12	100.0	0.0	0.0	7.61	0.2	e

Potassium CCA

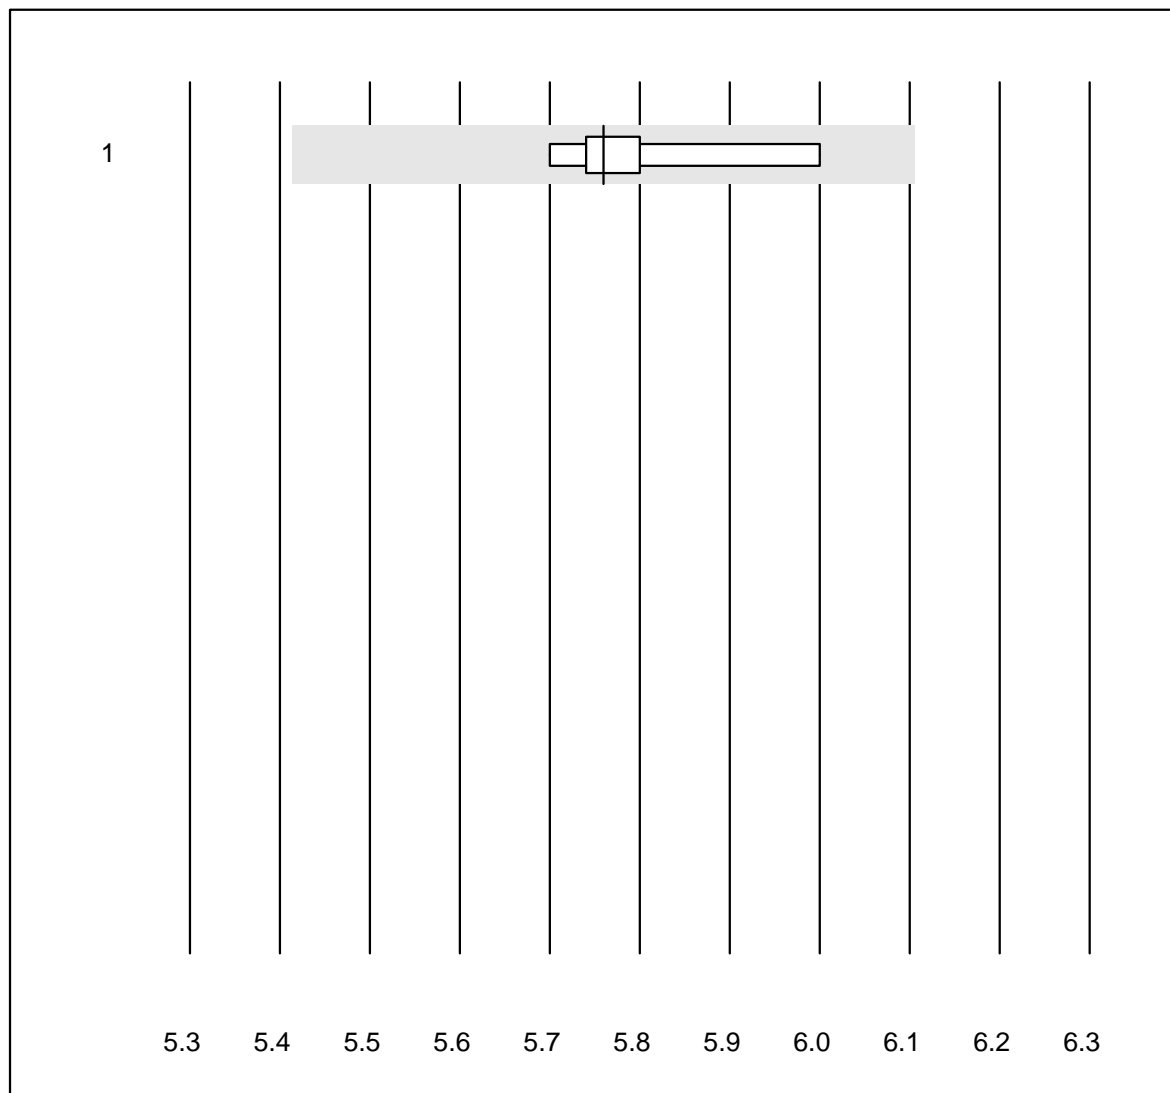


Tolérance QUALAB : 6 %

Potassium CCA (mmol/l)

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 OPTI CCA	5	100.0	0.0	0.0	5.8	2.0	e*

Sodium CCA

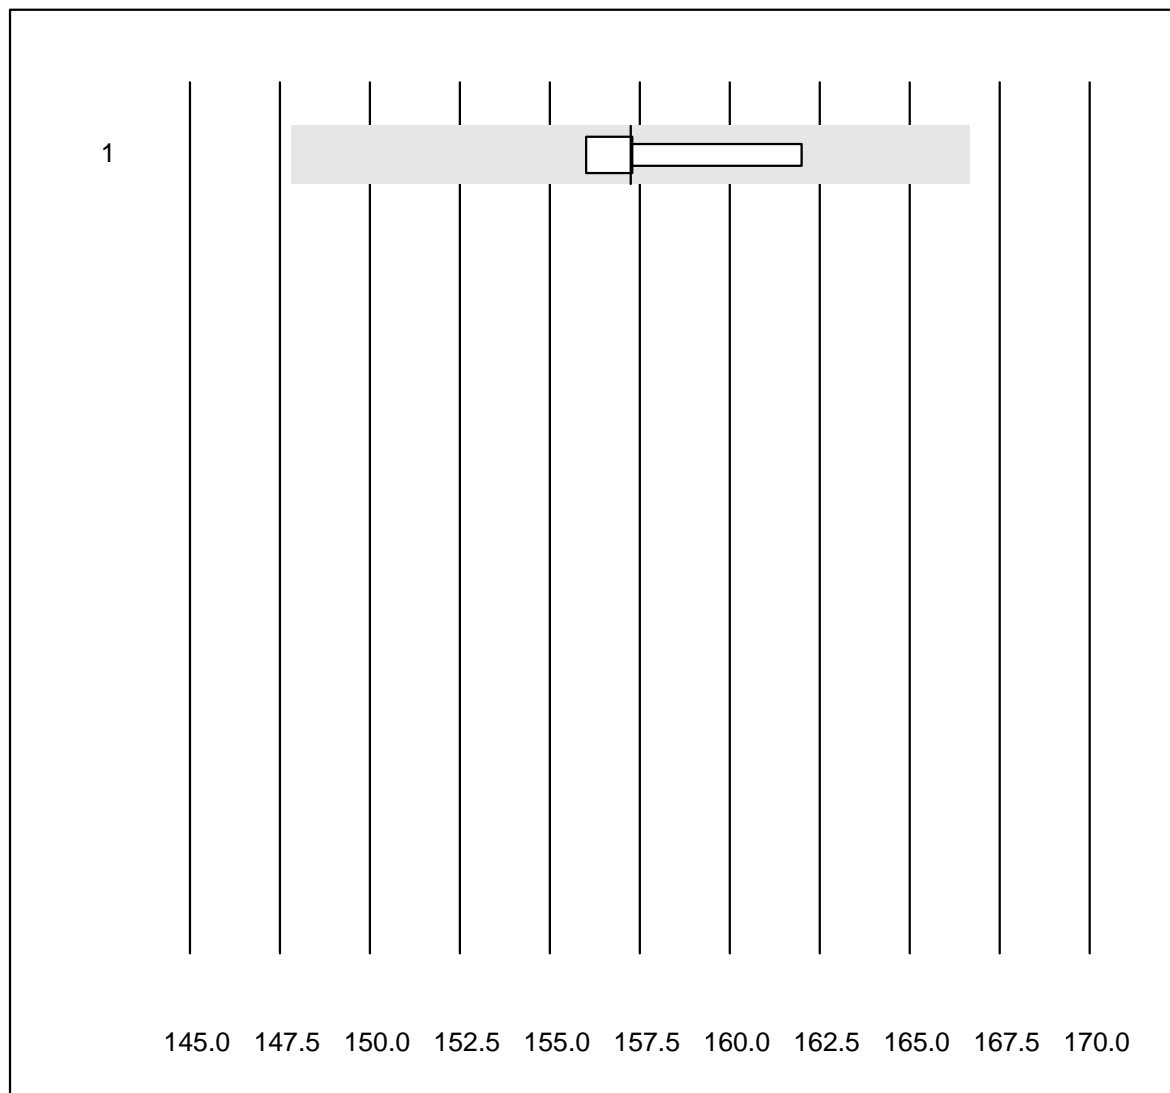


Tolérance QUALAB : 6 %

Sodium CCA (mmol/l)

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 OPTI CCA	4	100.0	0.0	0.0	157.3	1.7	e*

Ferritine

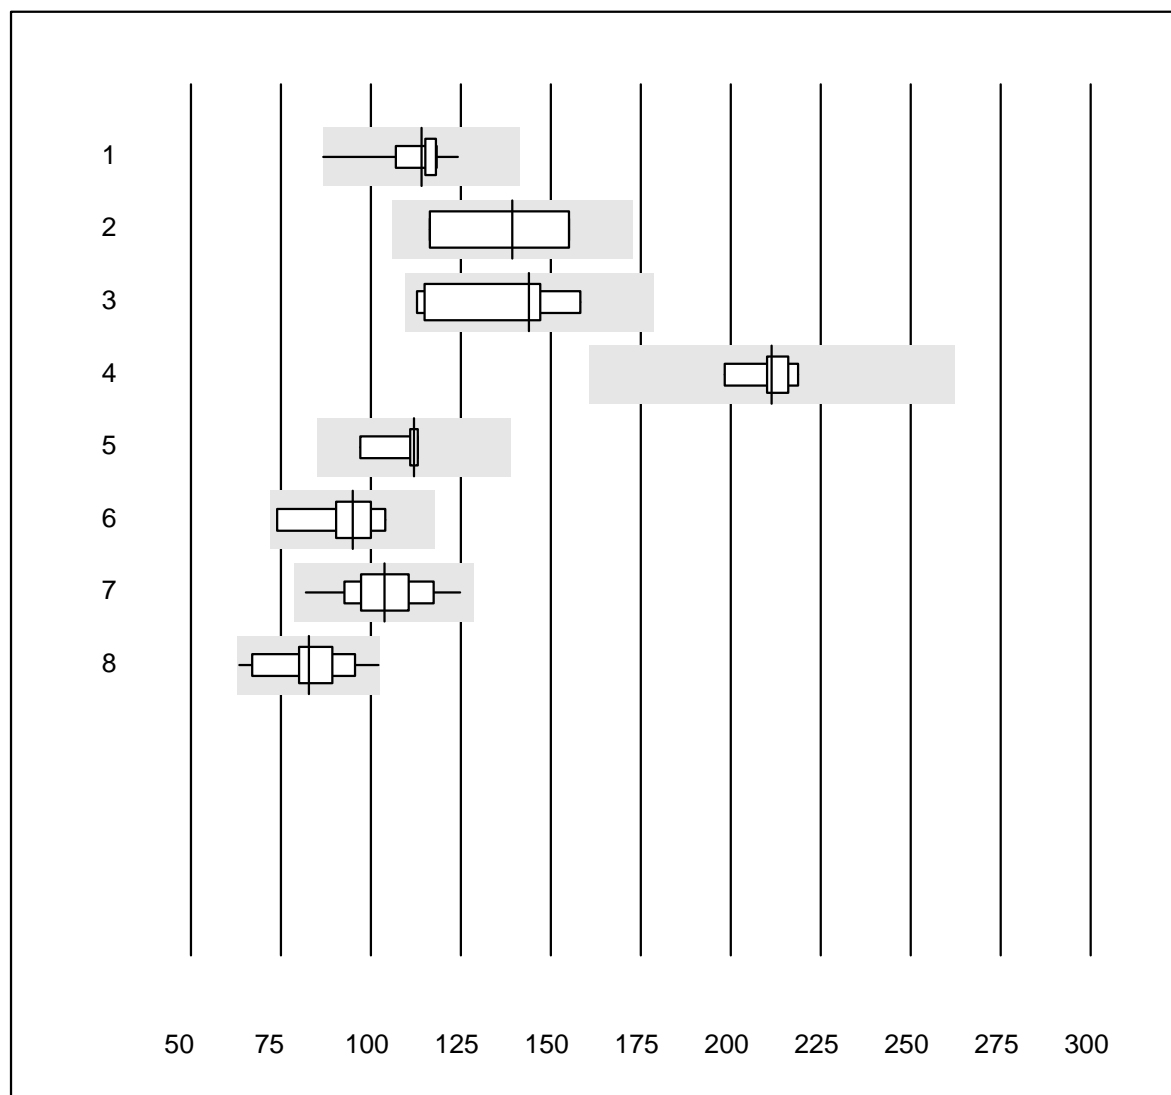


Tolérance QUALAB : 24 %

Ferritine (µg/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Beckman	13	100.0	0.0	0.0	114.06	7.9	e
2	toutes les méthodes	4	75.0	0.0	25.0	139.25	15.6	e*
3	Cobas E / Elecsys	8	100.0	0.0	0.0	144.00	13.0	e*
4	Architect	5	100.0	0.0	0.0	211.40	3.7	e
5	Mira/DiaSys	5	100.0	0.0	0.0	112.00	6.3	e
6	Mini Vidas	5	100.0	0.0	0.0	94.91	12.6	e*
7	AFIAS	22	100.0	0.0	0.0	103.71	9.6	e
8	Eurolyser	18	100.0	0.0	0.0	82.75	10.9	e

Vitamine B12

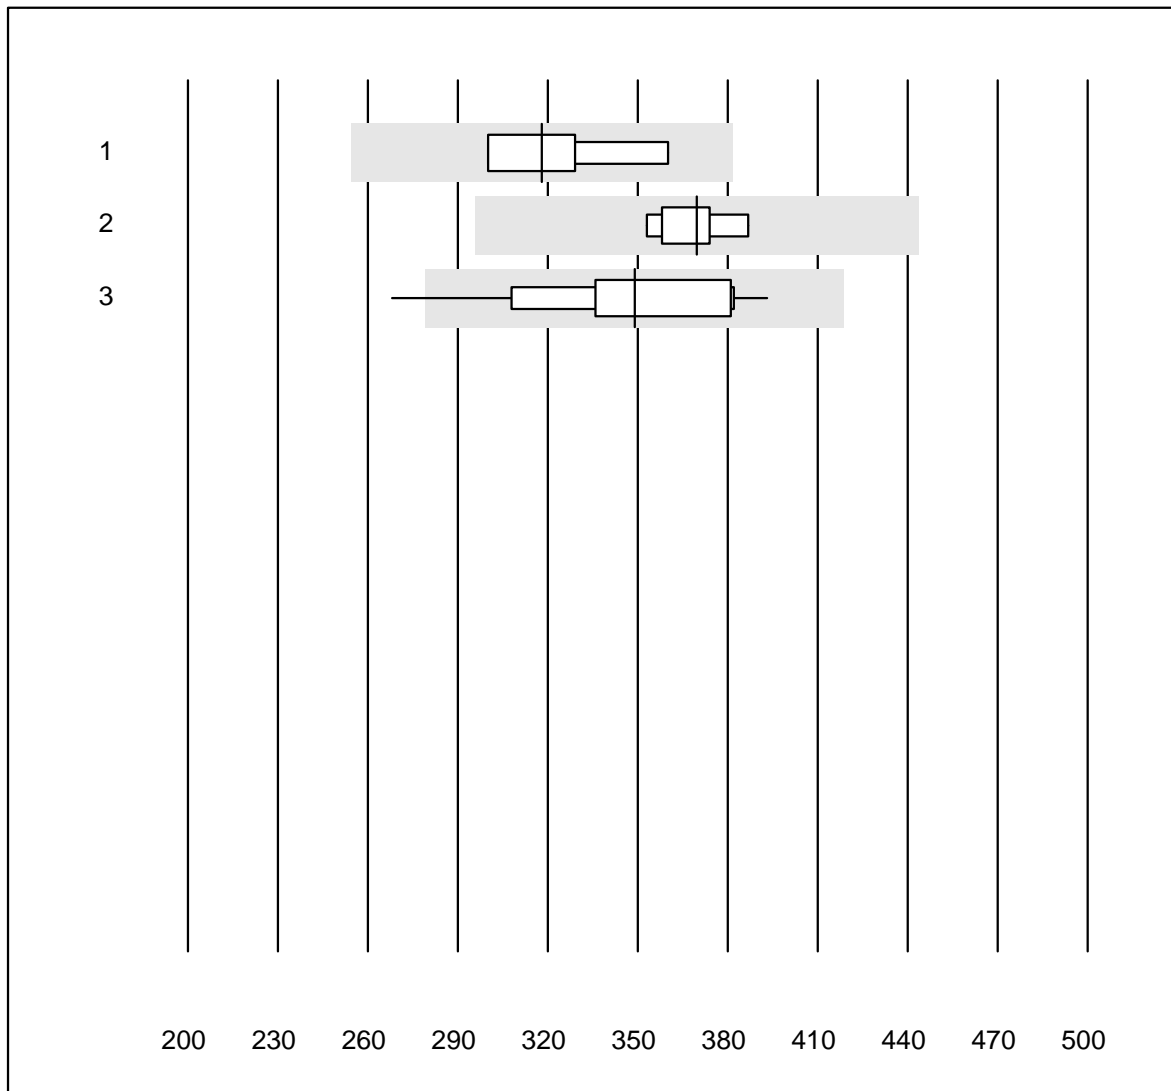


Tolérance QUALAB : 20 %

Vitamine B12 (pmol/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	318.00	8.3	e*
2 Cobas E / Elecsys	8	100.0	0.0	0.0	369.65	2.9	e
3 Architect	11	90.9	9.1	0.0	349.03	10.4	e*

Folate

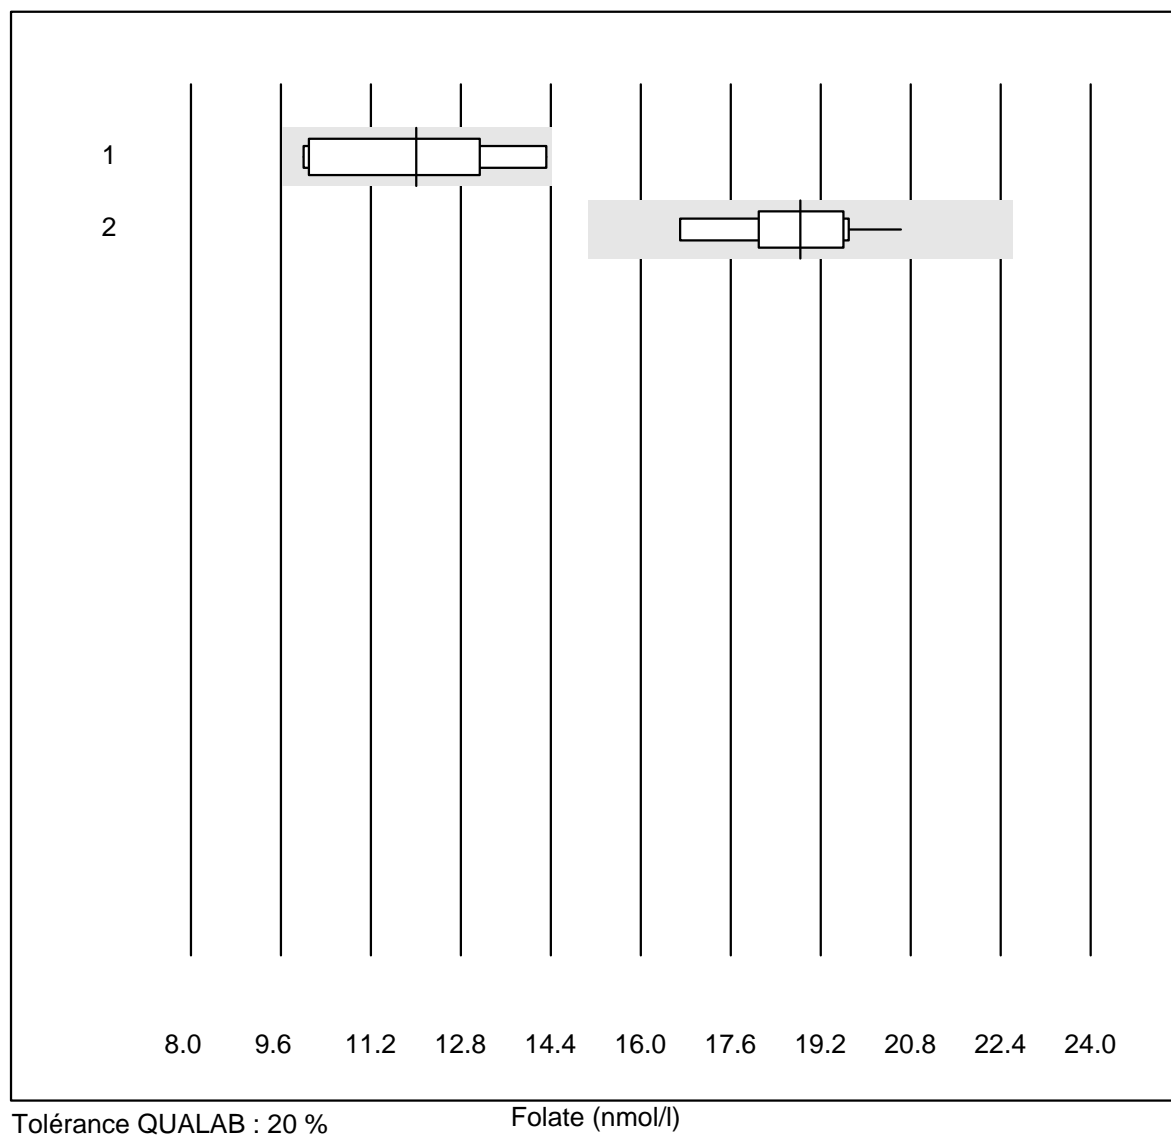

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	8	100.0	0.0	0.0	12.01	14.0	e*
2 Architect	10	100.0	0.0	0.0	18.84	5.9	e

Holotranscobalamine

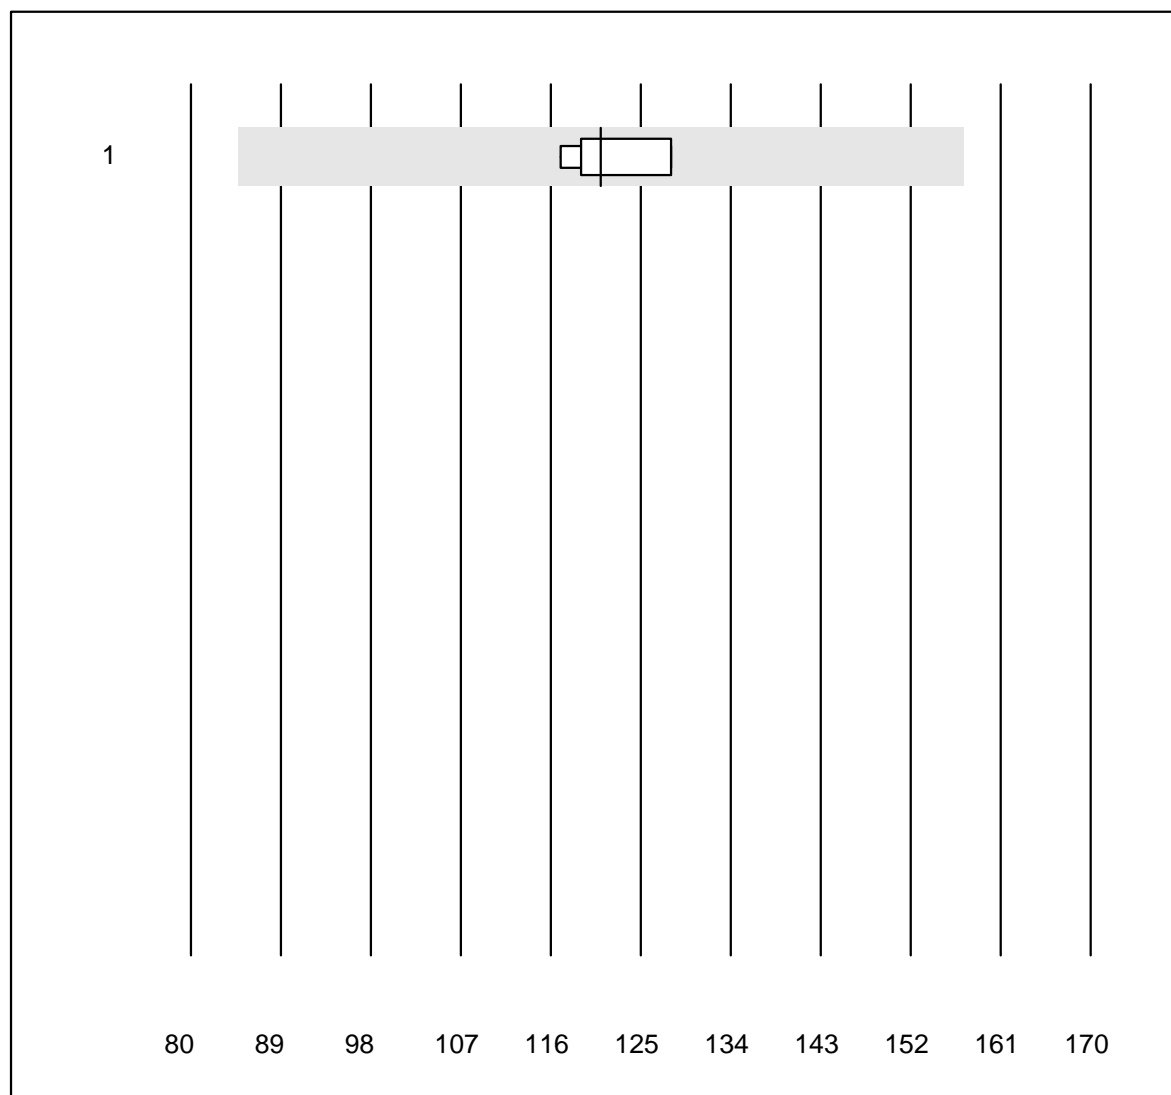


Tolérance QUALAB : 30 %

Holotranscobalamine (pmol/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Architect	5	100.0	0.0	0.0	121	4.2	e

Bilirubin totale Neo

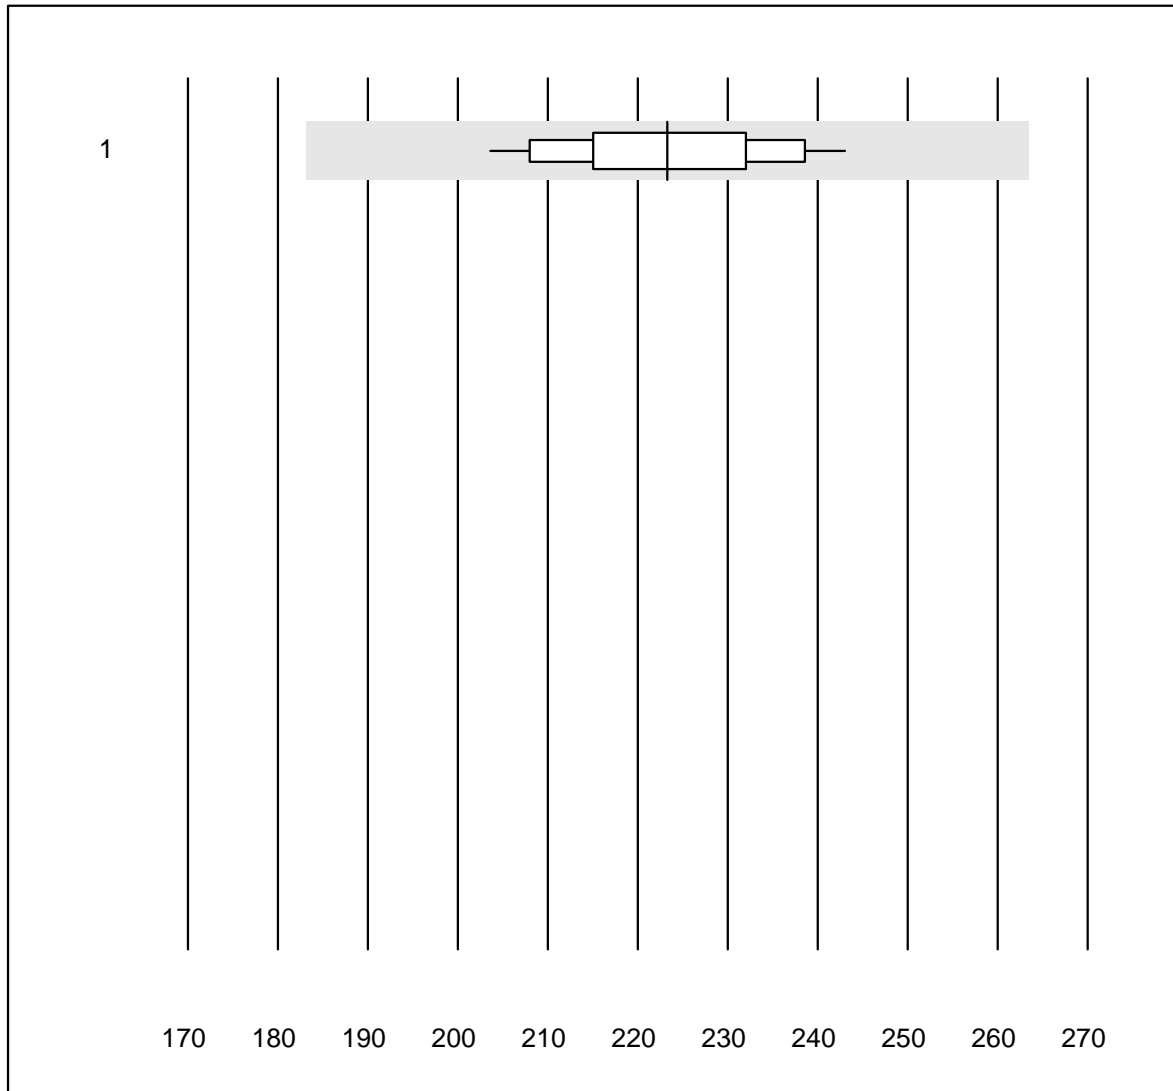


Tolérance QUALAB : 18 %

Bilirubin totale Neo ($\mu\text{mol/l}$)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	16	100.0	0.0	0.0	223	5.0	e

Bilirubin directe

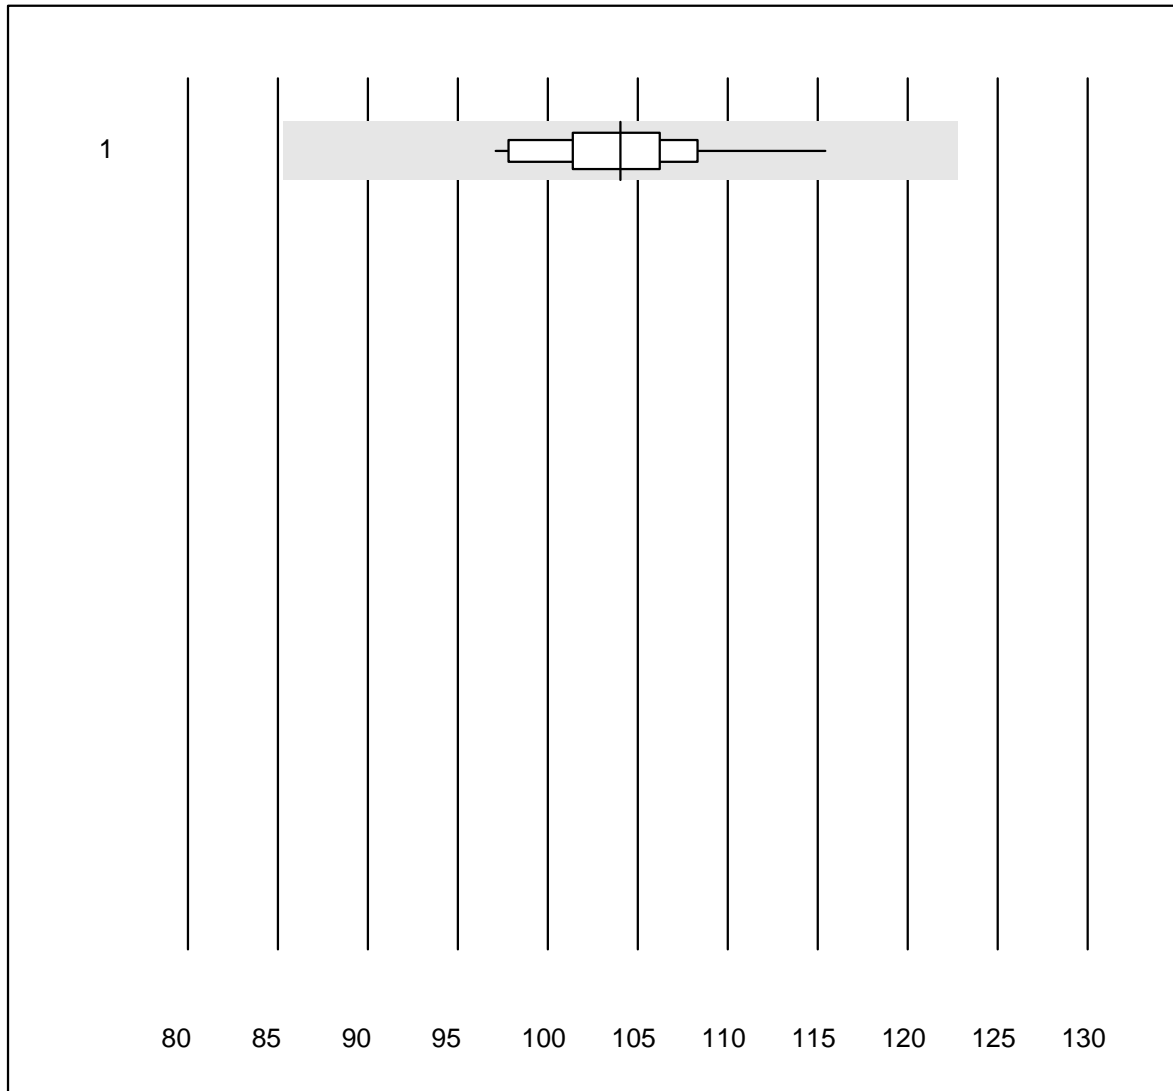


Tolérance QUALAB : 18 %

Bilirubin directe (µmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	14	100.0	0.0	0.0	104	4.6	e

Bilirubin néonatale

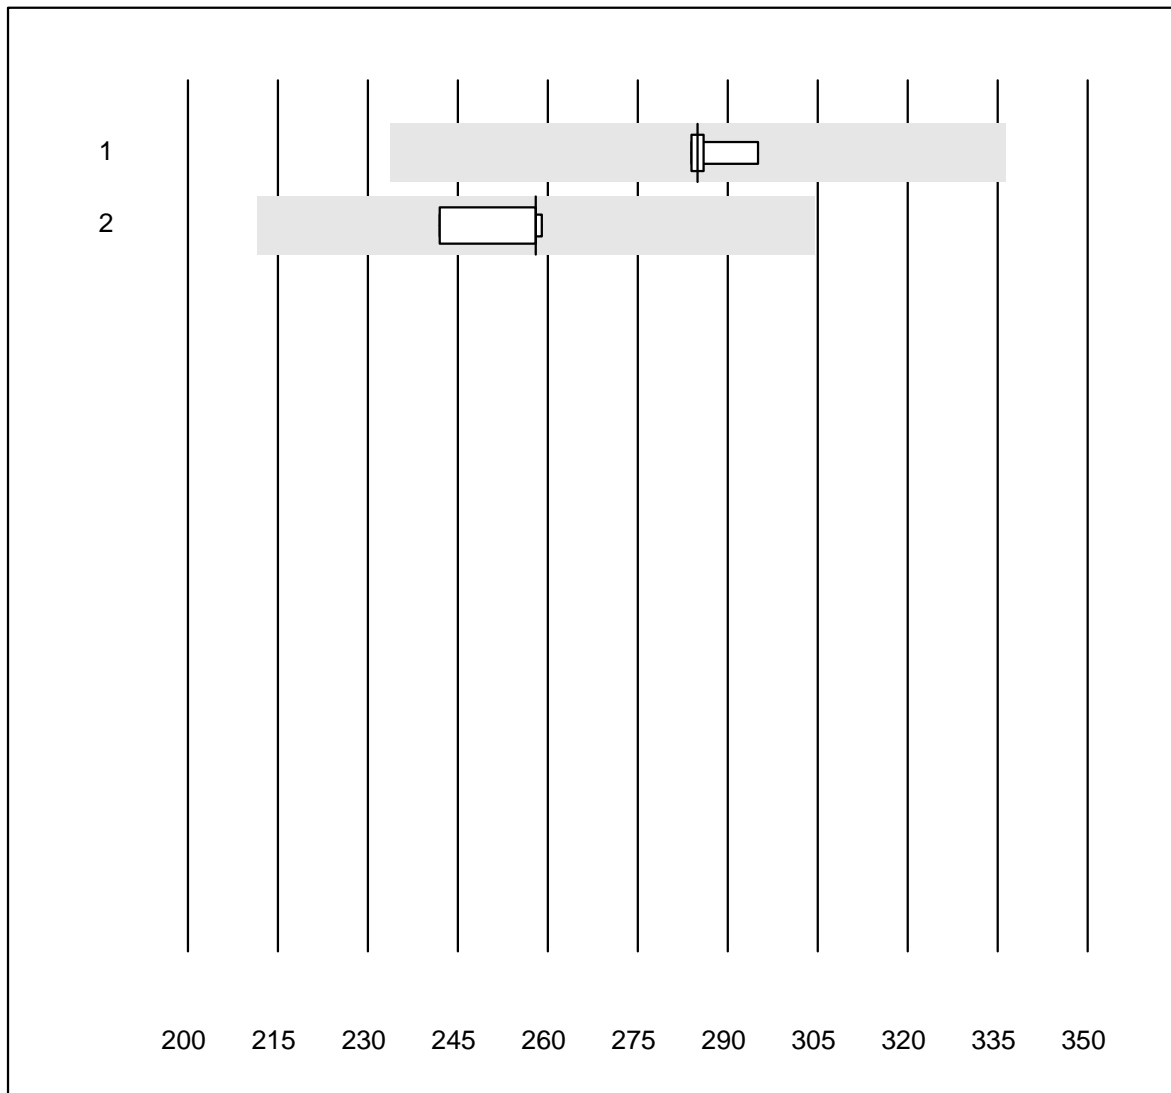


Tolérance QUALAB : 18 %

Bilirubin néonatale (µmol/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	285	1.6	e
2	ABL700/800	4	100.0	0.0	0.0	258	3.2	e

PSA

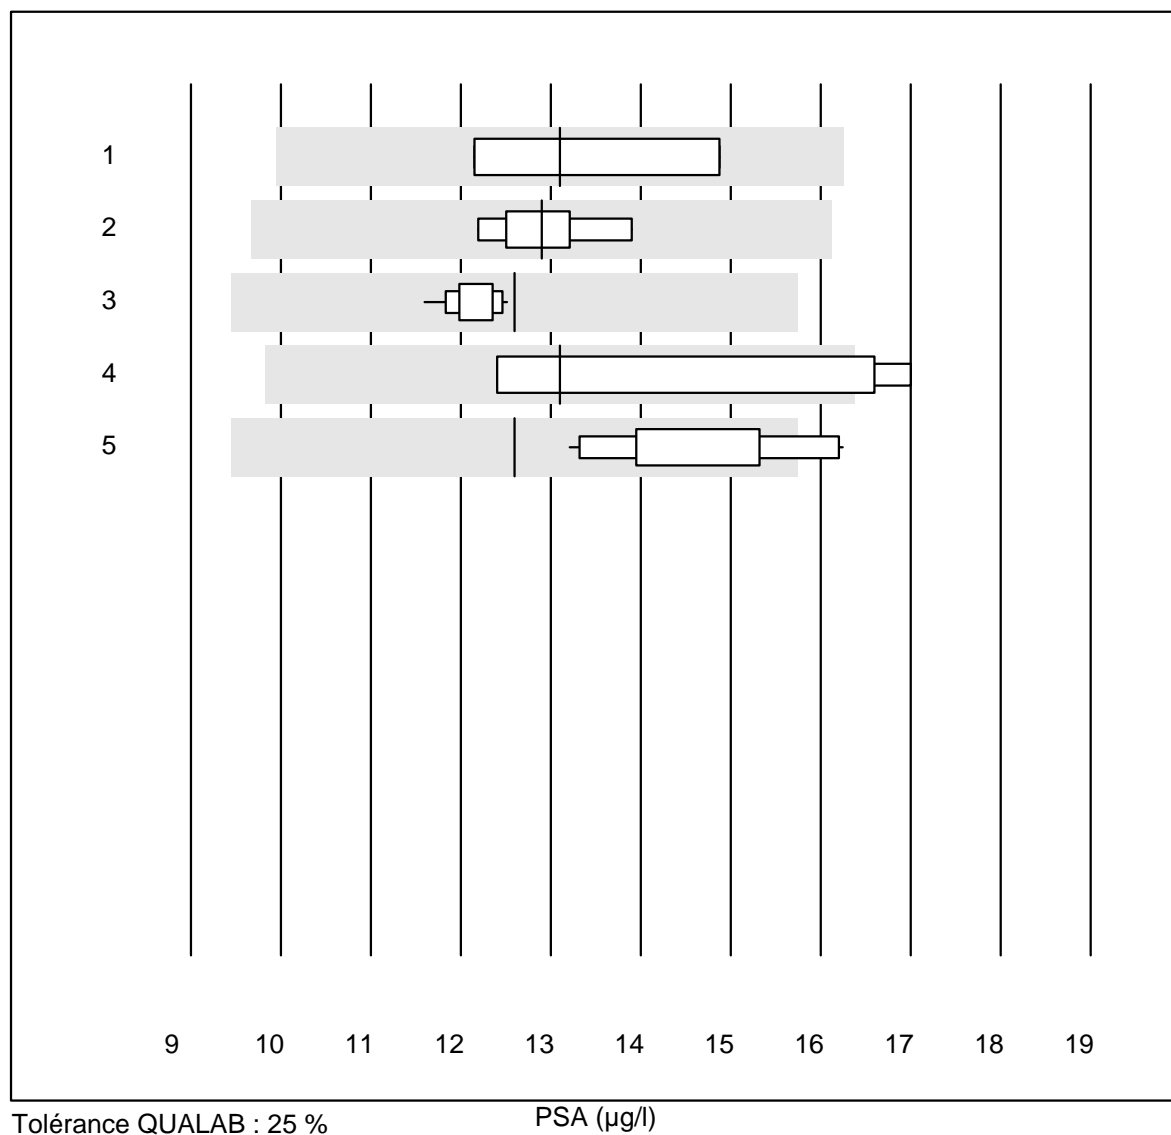

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Autres méthodes	4	75.0	0.0	25.0	13.10	10.1	a
2	Cobas E / Elecsys	9	100.0	0.0	0.0	12.90	4.9	a
3	Architect	12	100.0	0.0	0.0	12.60	2.3	a
4	Qualigen	5	40.0	40.0	20.0	13.10	14.3	a
5	AFIAS	18	77.7	16.7	5.6	12.60	6.5	a

PSA frei

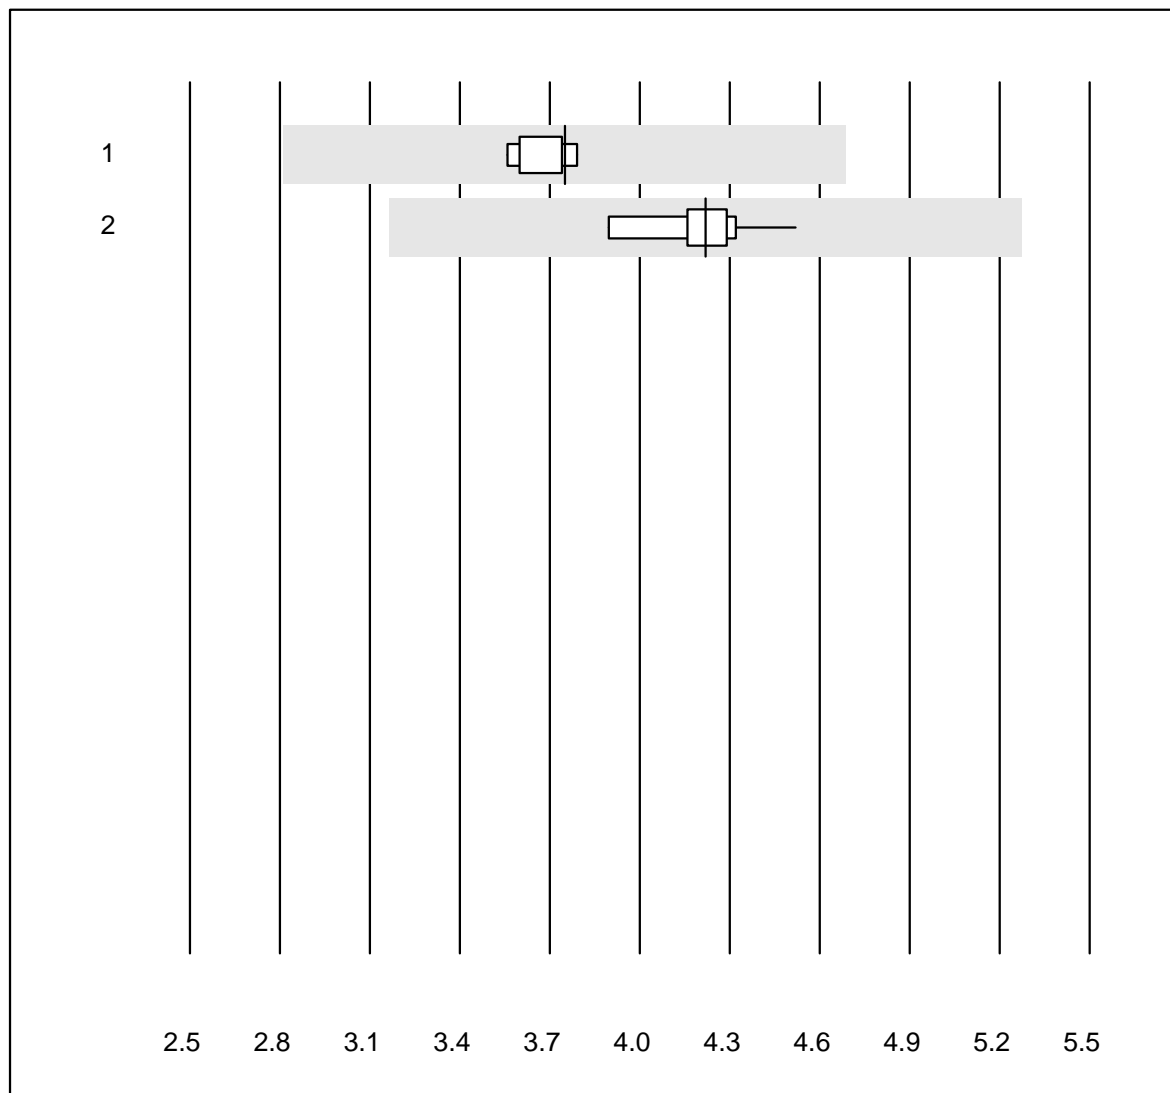


Tolérance QUALAB : 25 %

PSA frei (µg/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	5	100.0	0.0	0.0	3.75	2.8	a
2	Architect	10	100.0	0.0	0.0	4.22	3.9	a

CEA

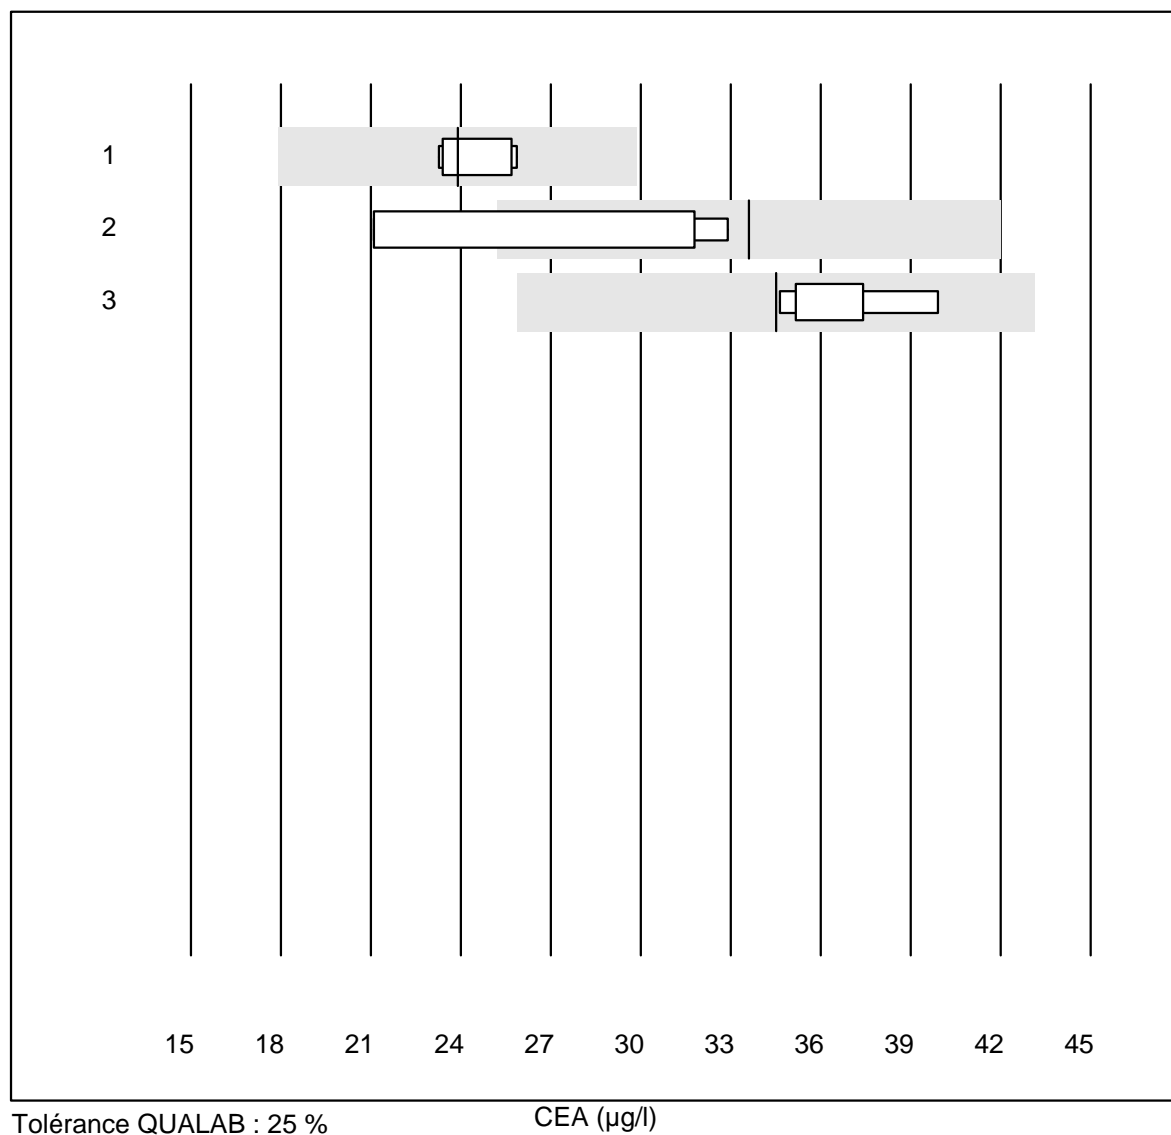

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	6	100.0	0.0	0.0	23.9	4.8	a
2 ADVIA Centaur XP/CP	4	75.0	25.0	0.0	33.6	18.6	a
3 Architect	9	88.9	0.0	11.1	34.5	4.7	a

CA 125

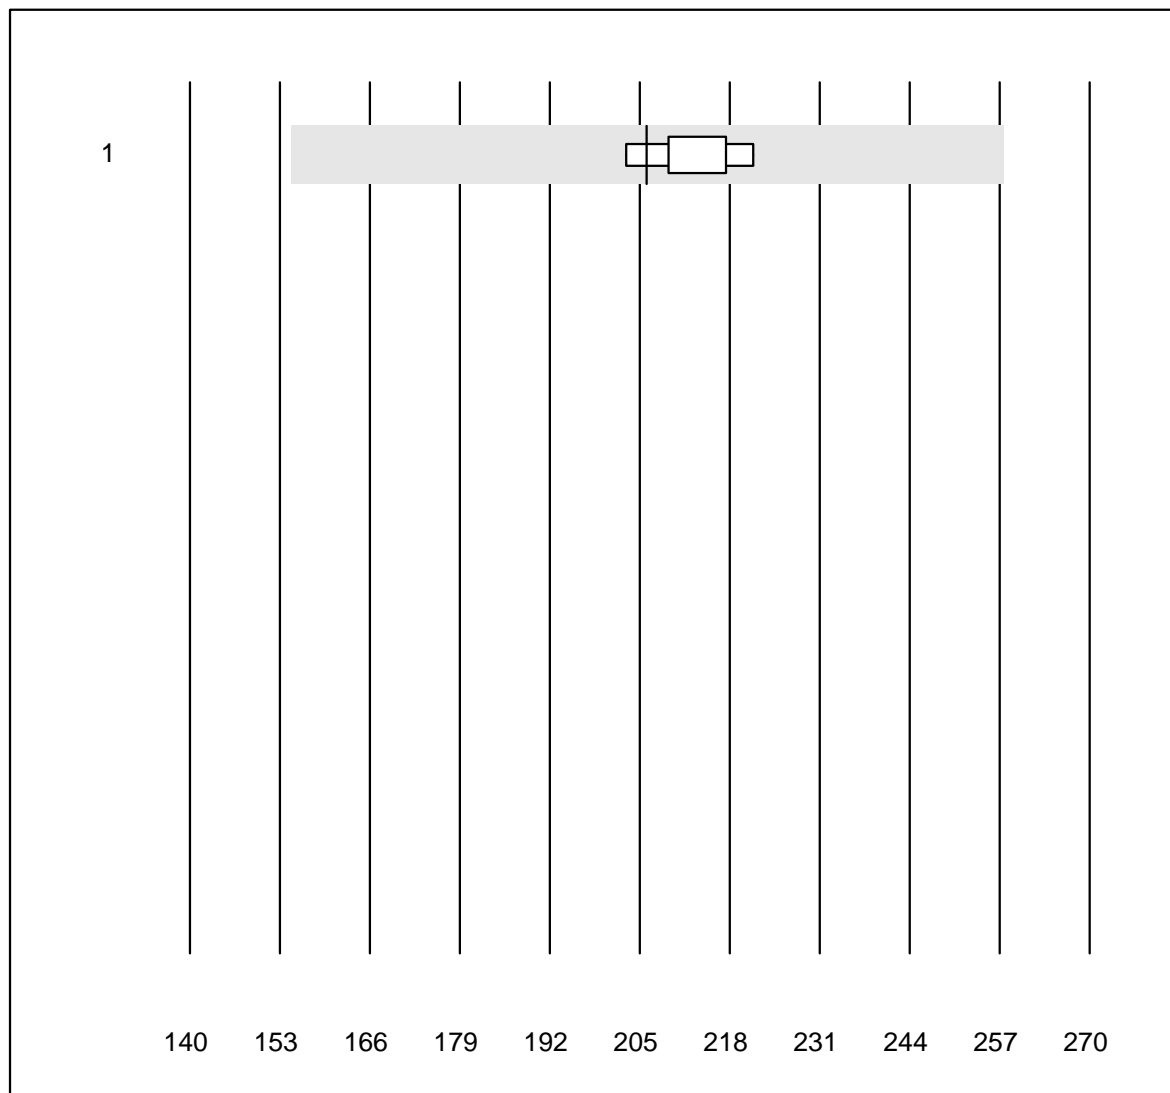


Tolérance QUALAB : 25 %

CA 125 (kIU/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Architect	6	100.0	0.0	0.0	206.0	3.2	a

CA 19-9

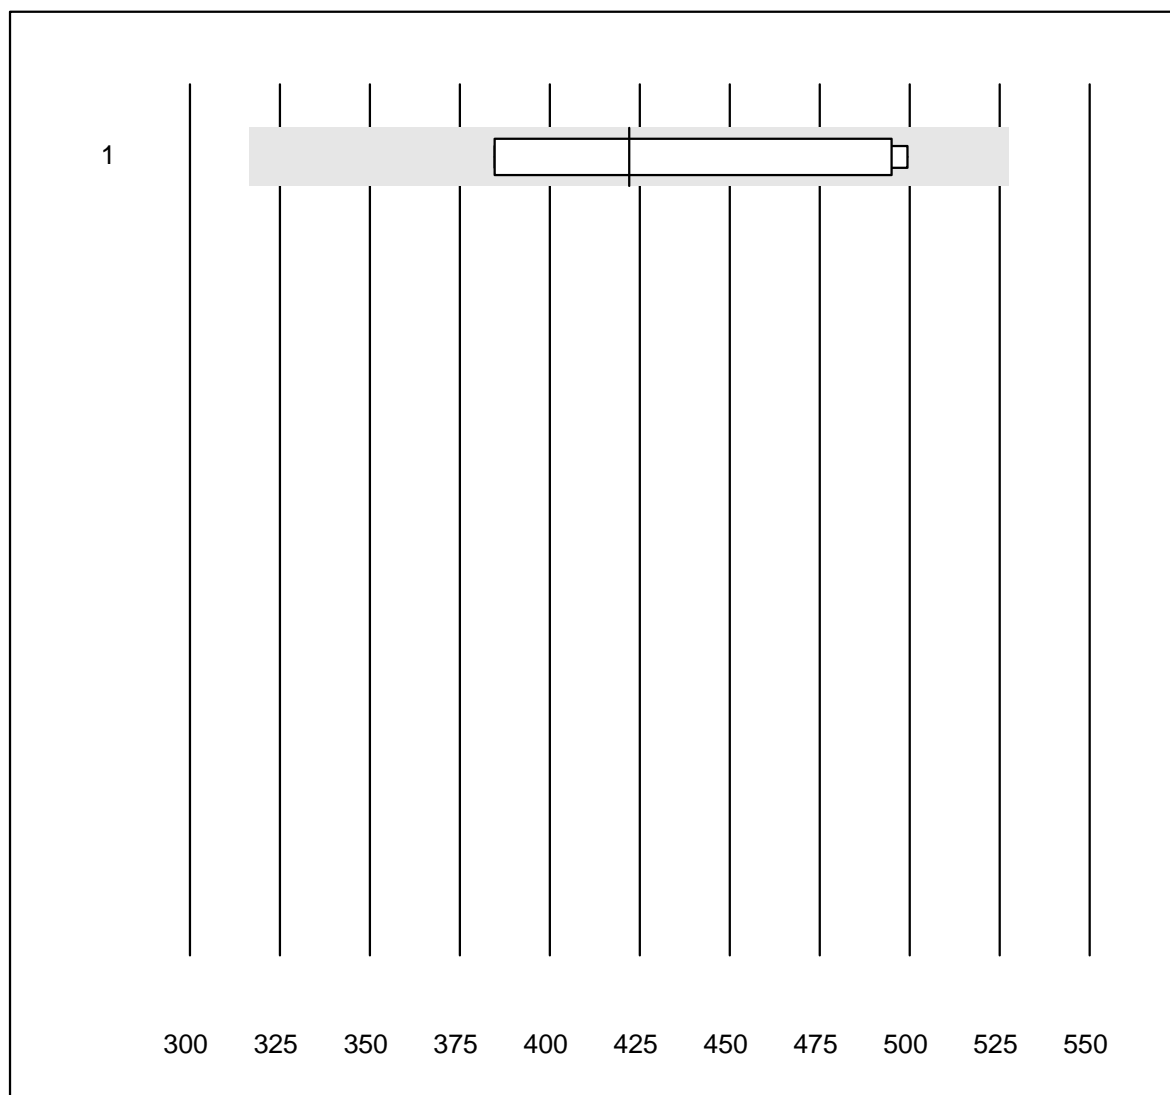


Tolérance QUALAB : 25 %

CA 19-9 (kIU/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Architect	4	100.0	0.0	0.0	422.0	13.1	a

CA 15-3

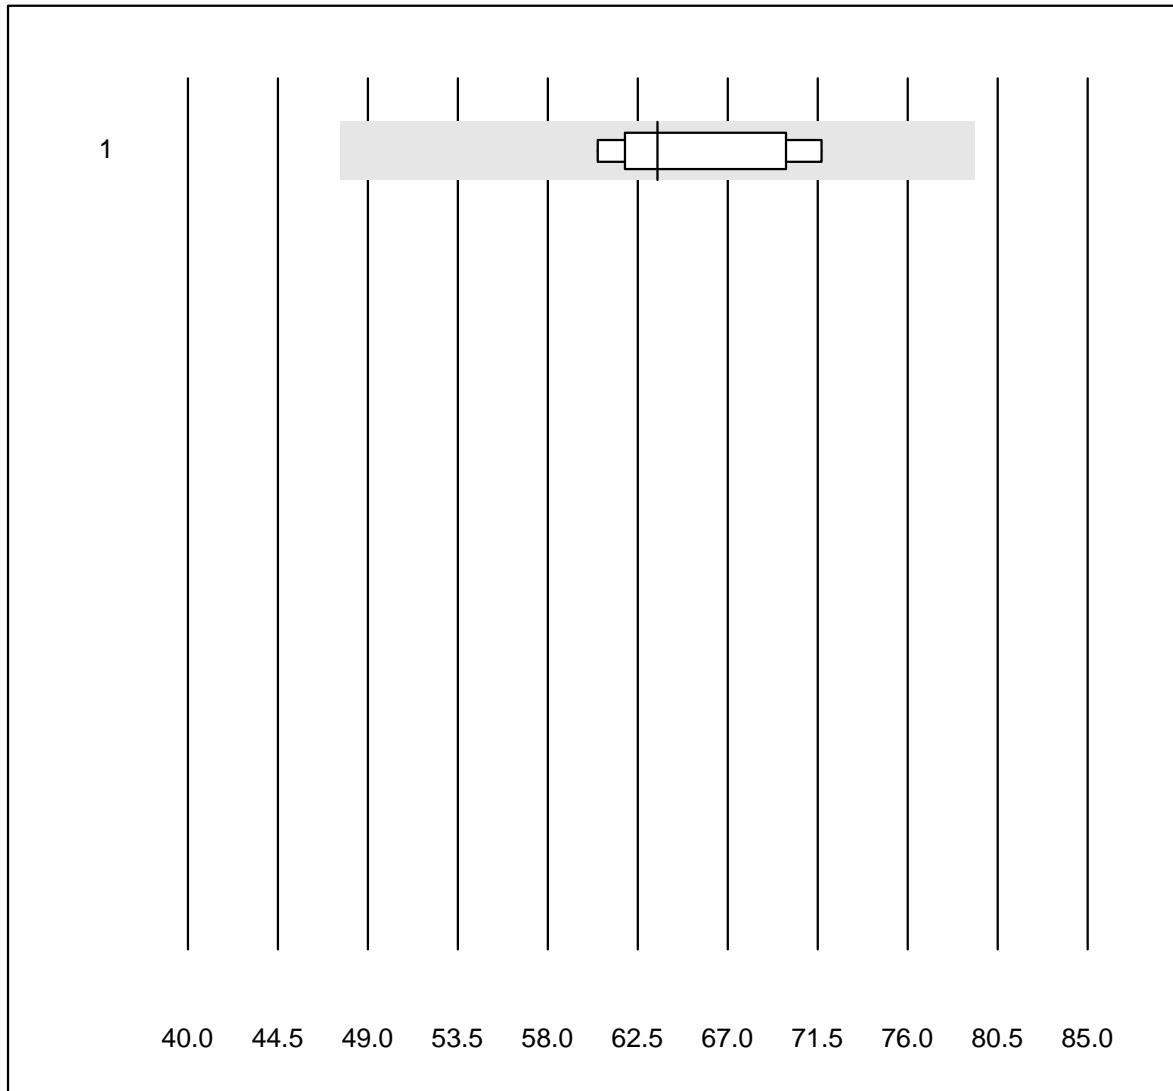


Tolérance QUALAB : 25 %

CA 15-3 (kIU/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Architect	6	100.0	0.0	0.0	63.5	7.0	a

AFP

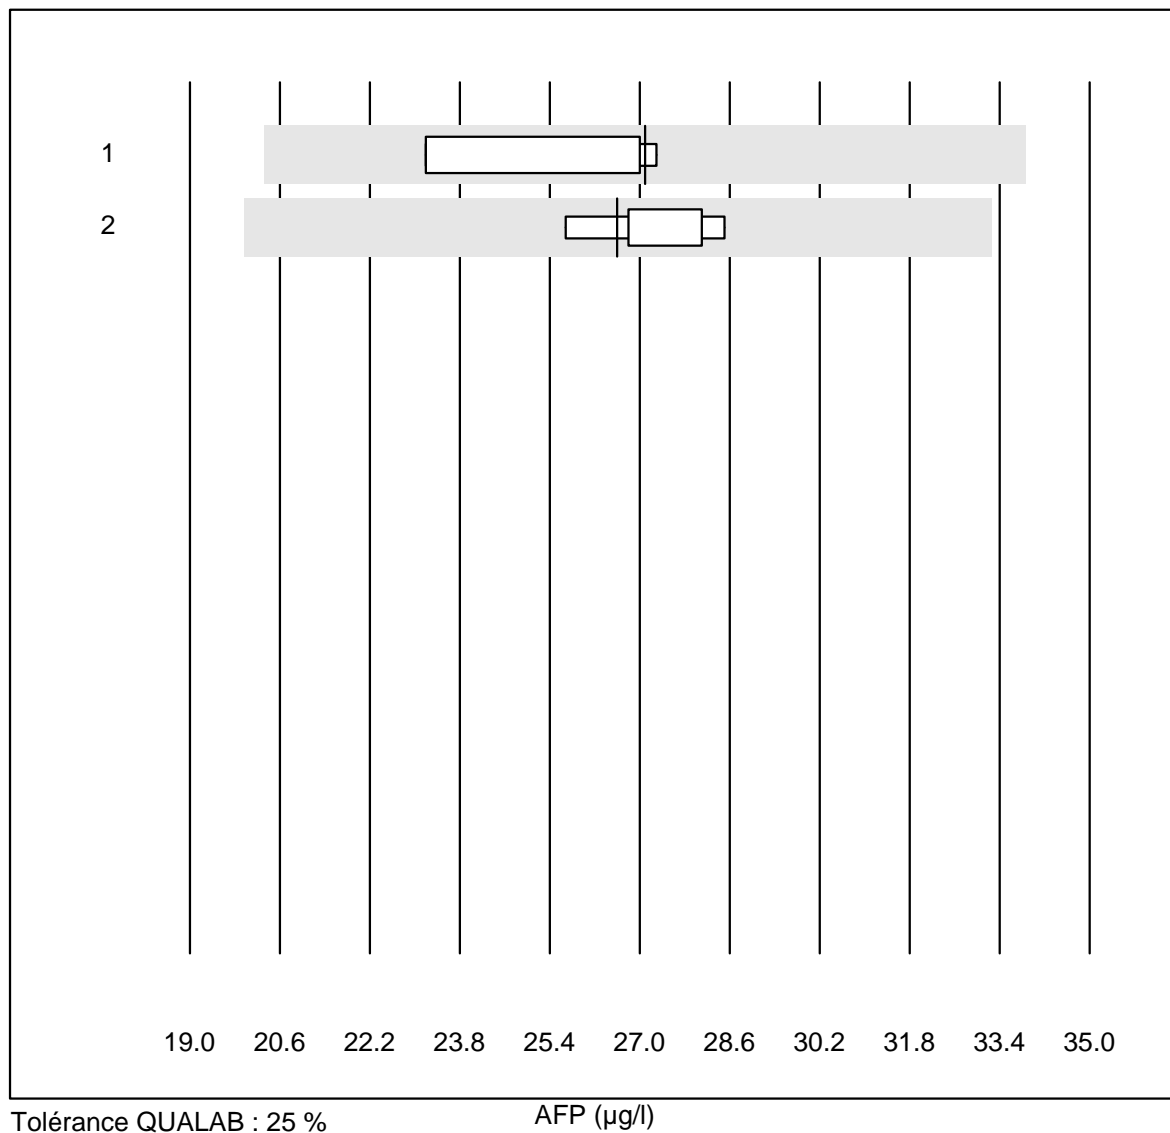


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	4	100.0	0.0	0.0	27	7.2	a
2 Architect	6	100.0	0.0	0.0	27	3.8	a

HCG qn

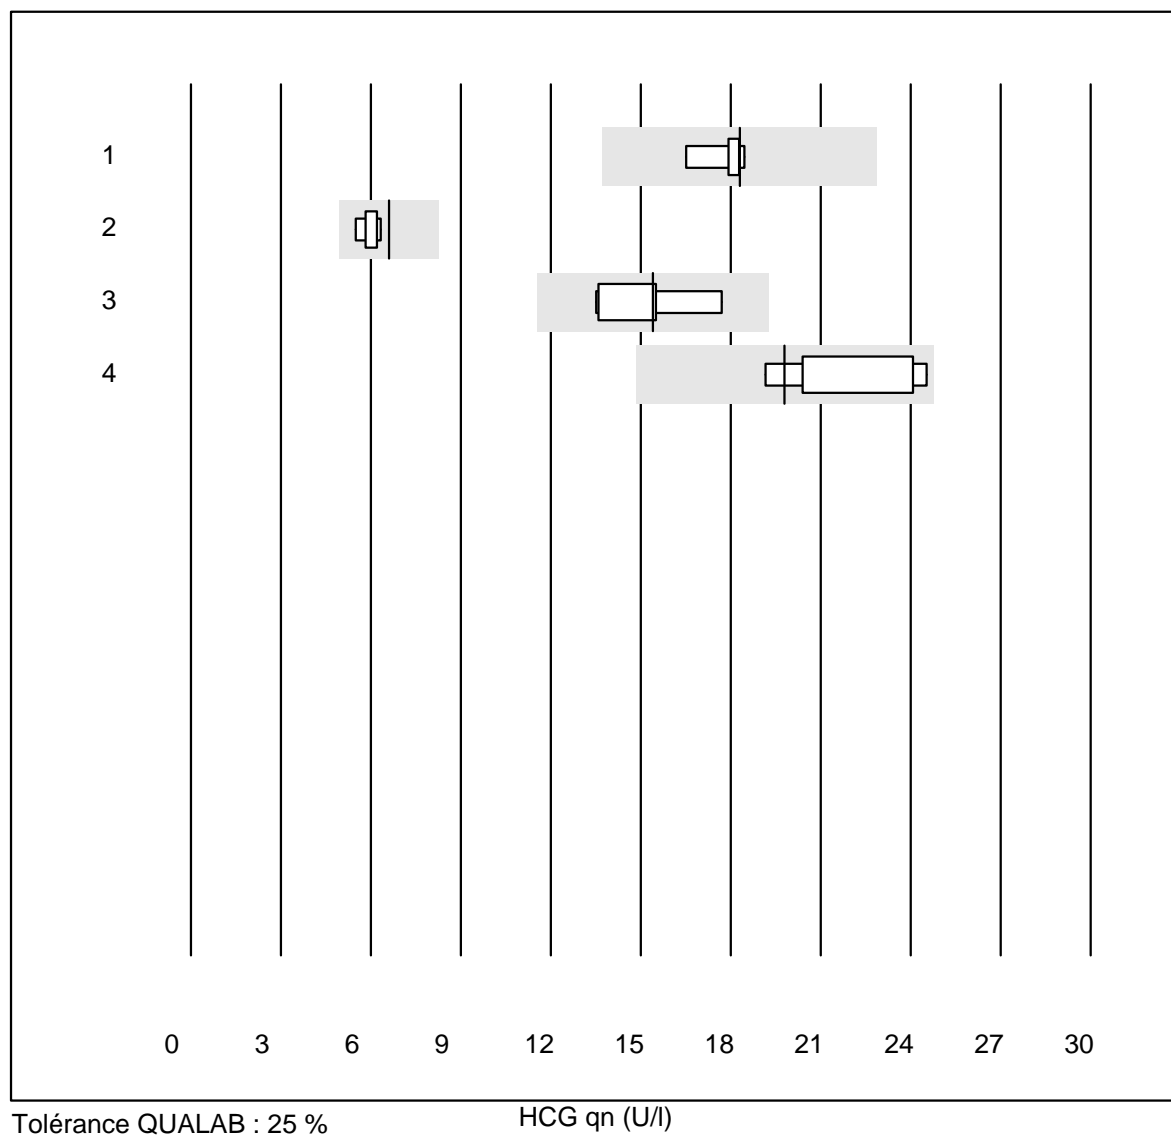


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	5	100.0	0.0	0.0	18	4.4	a
2	VIDAS	9	100.0	0.0	0.0	7	4.7	a
3	Architect	6	100.0	0.0	0.0	15	10.5	a
4	AFIAS	7	85.7	0.0	14.3	20	9.9	a

CK-MB

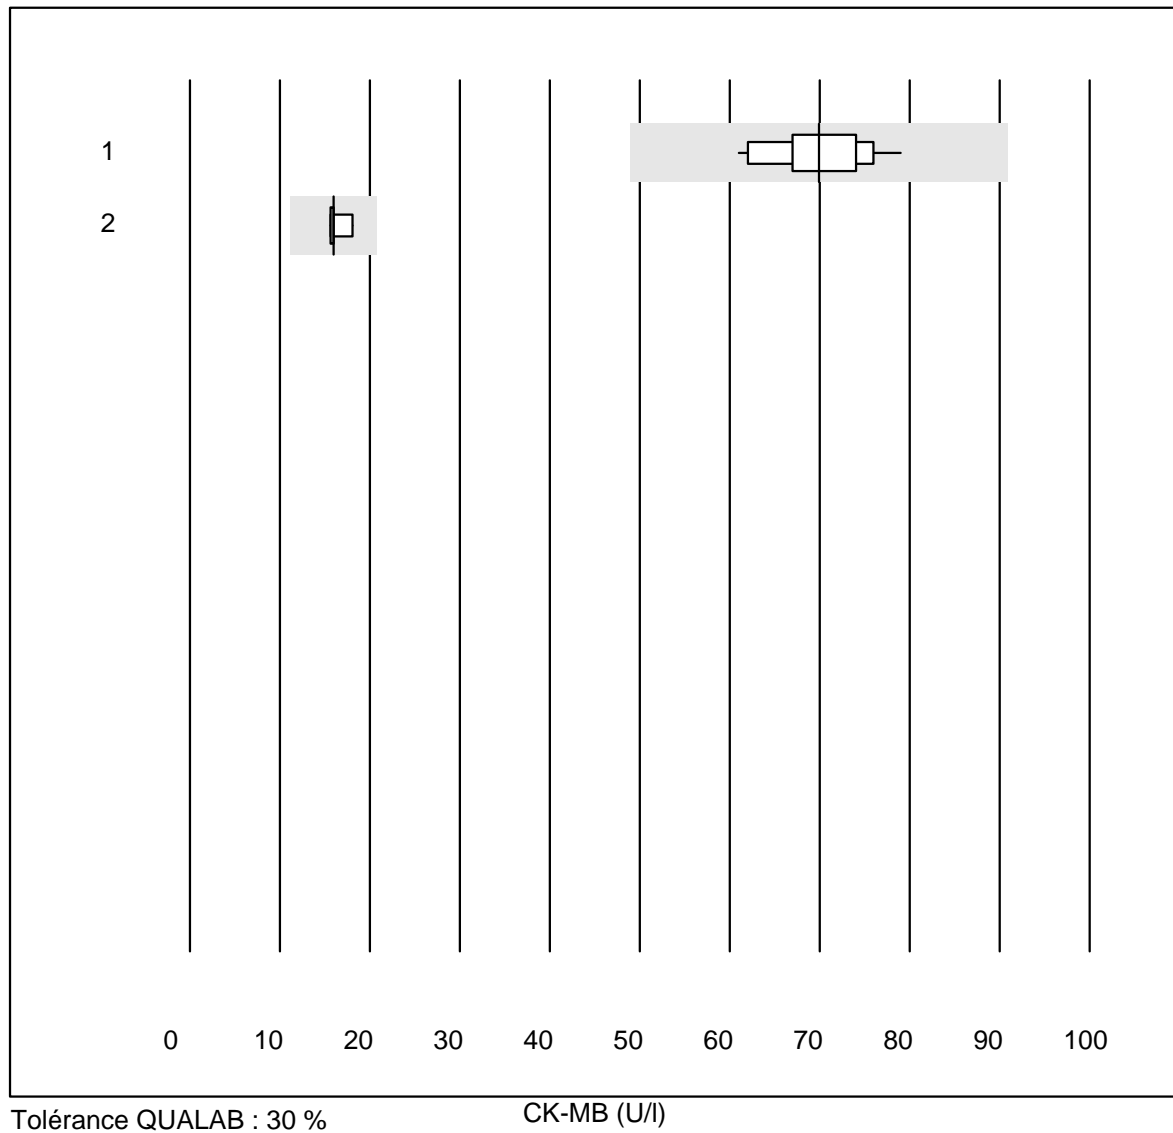

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Fuji Dri-Chem	40	100.0	0.0	0.0	70.0	7.3	e
2 Cobas/Roche	4	100.0	0.0	0.0	16.0	6.9	e

BNP

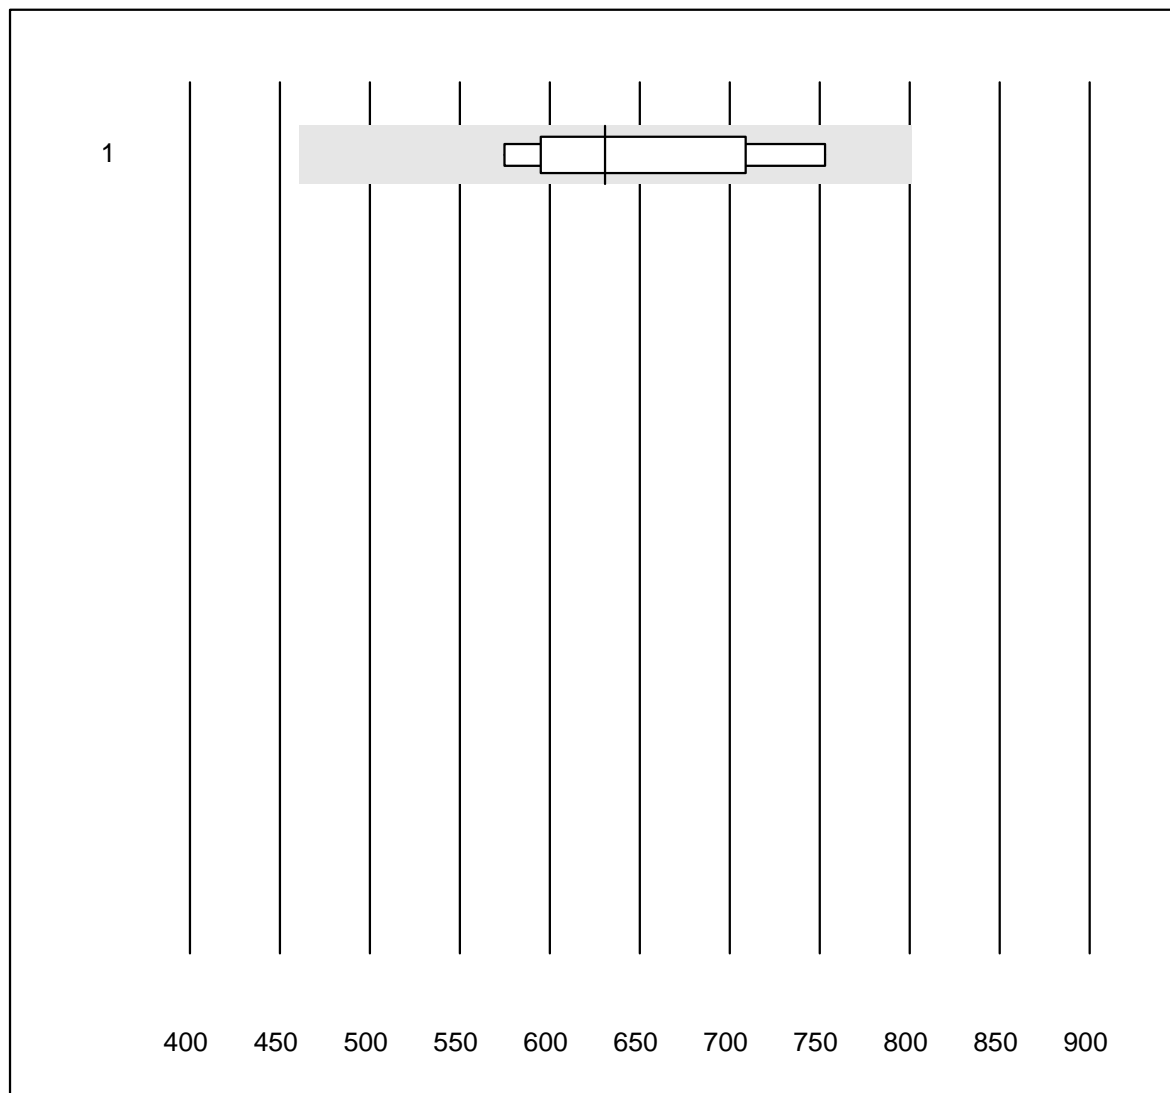


Tolérance QUALAB : 27 %

BNP (ng/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Architect	6	100.0	0.0	0.0	630.7	10.7	e*

NT-proBNP

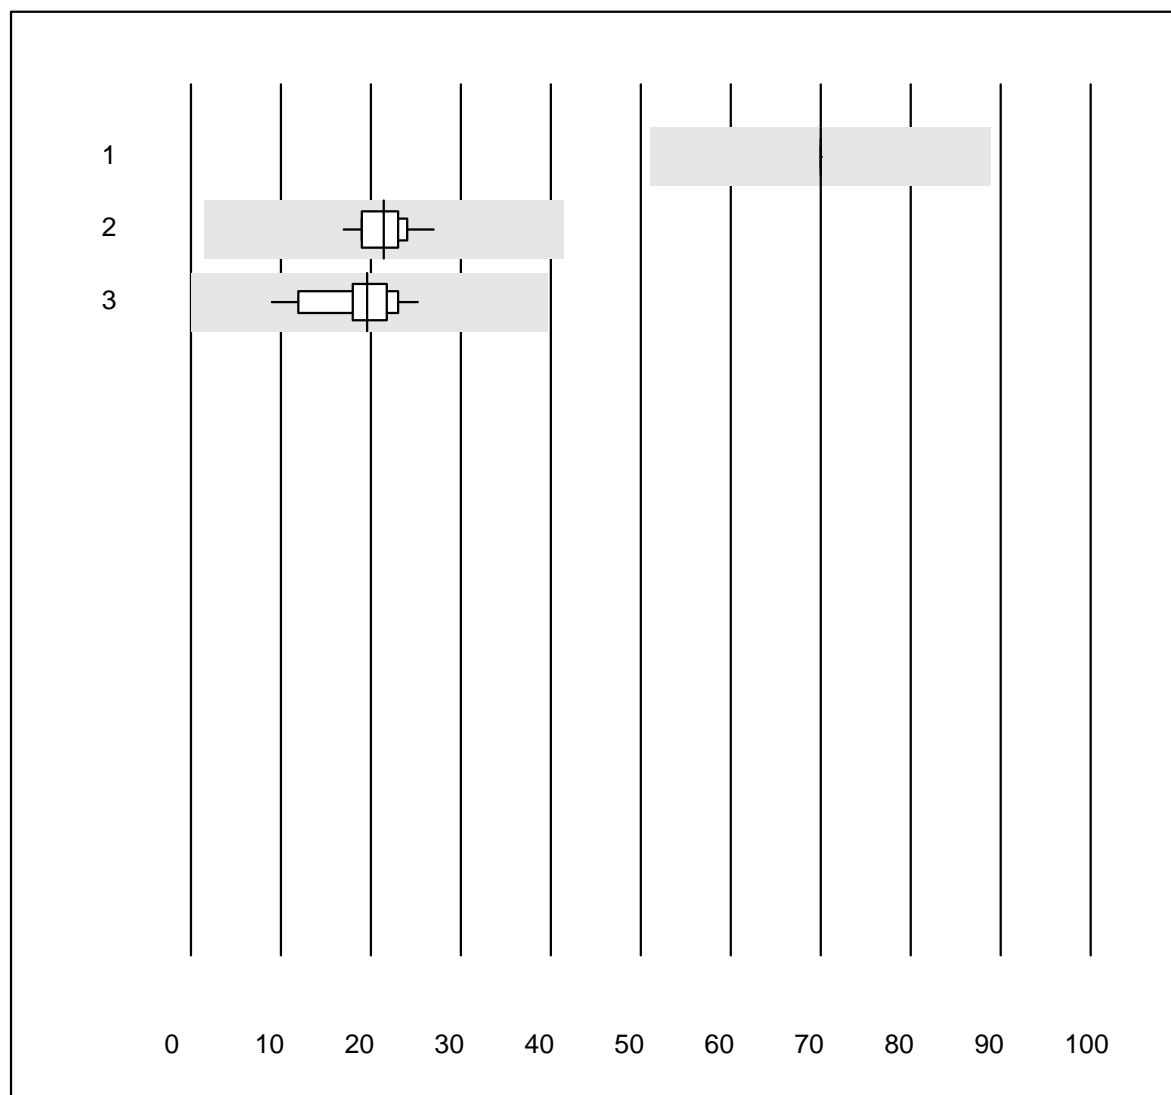


Tolérance QUALAB : 27 %
(< 75.0: +/- 20.0 ng/l)

NT-proBNP (ng/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	AQT 90 FLEX	7	100.0	0.0	0.0	70.0	0.0	e
2	VIDAS	11	100.0	0.0	0.0	21.5	13.6	e*
3	Cobas E / Elecsys	13	100.0	0.0	0.0	19.6	23.3	e*

Cholesterin PTS

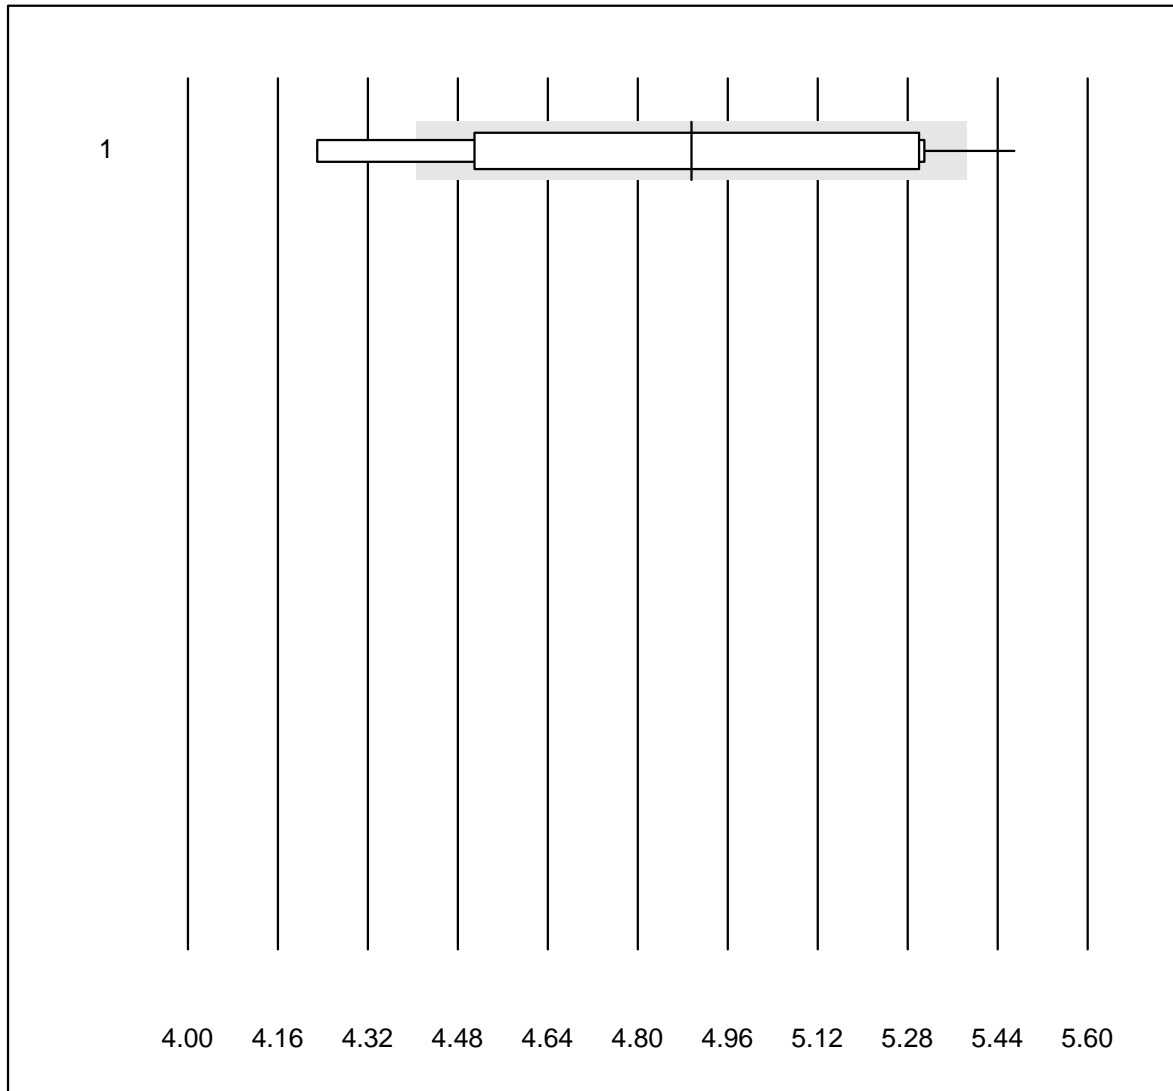


Tolérance QUALAB : 10 %

Cholesterin PTS (mmol/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 CardioChek	10	80.0	20.0	0.0	4.90	8.7	e*


Cholesterin HDL PTS

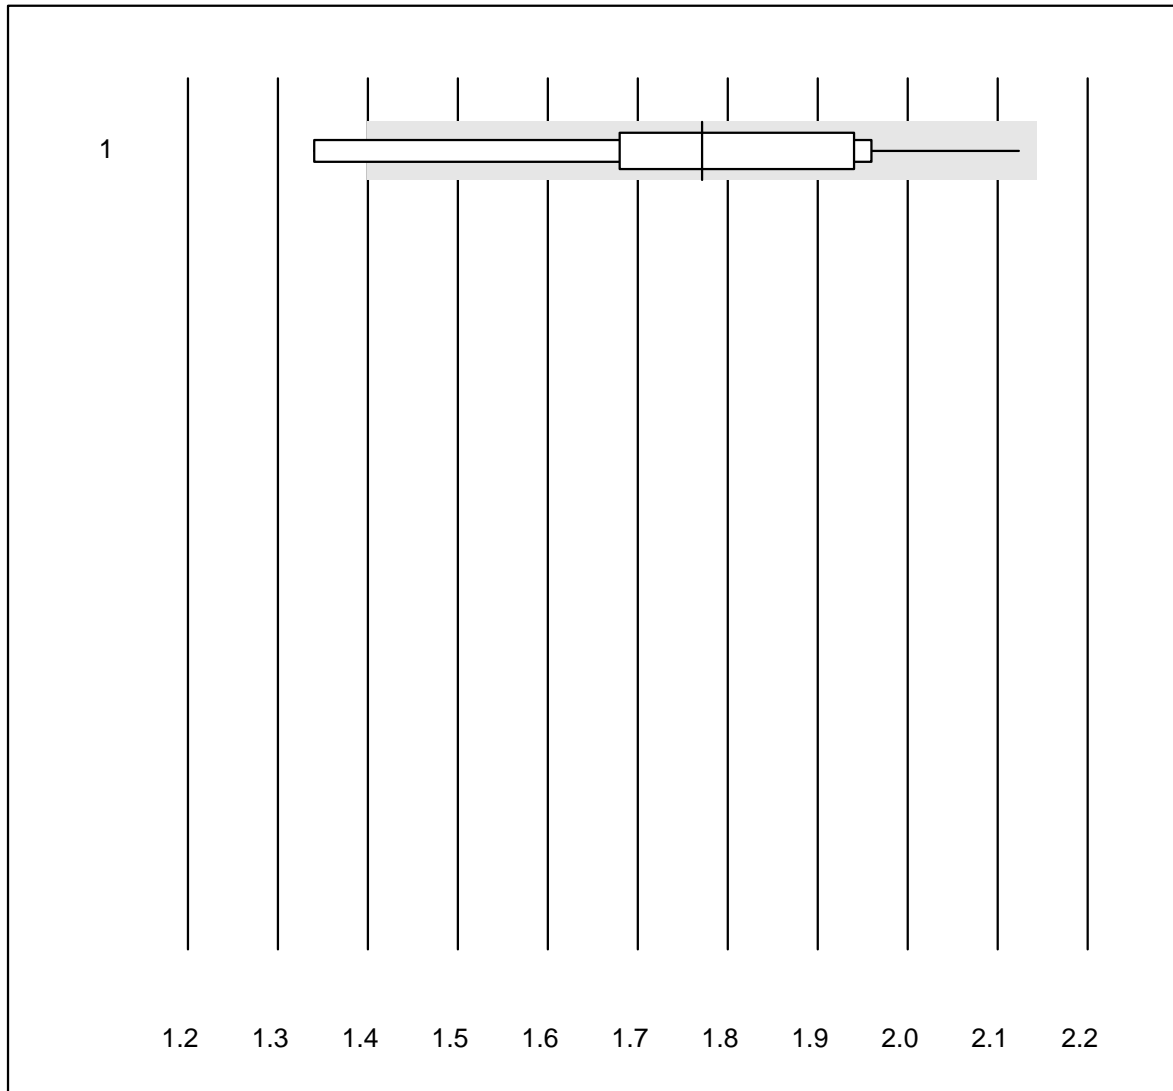

Tolérance QUALAB : 21 % Cholesterin HDL PTS (mmol/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 CardioChek	10	90.0	10.0	0.0	1.77	12.2	e*

Triglyceride PTS

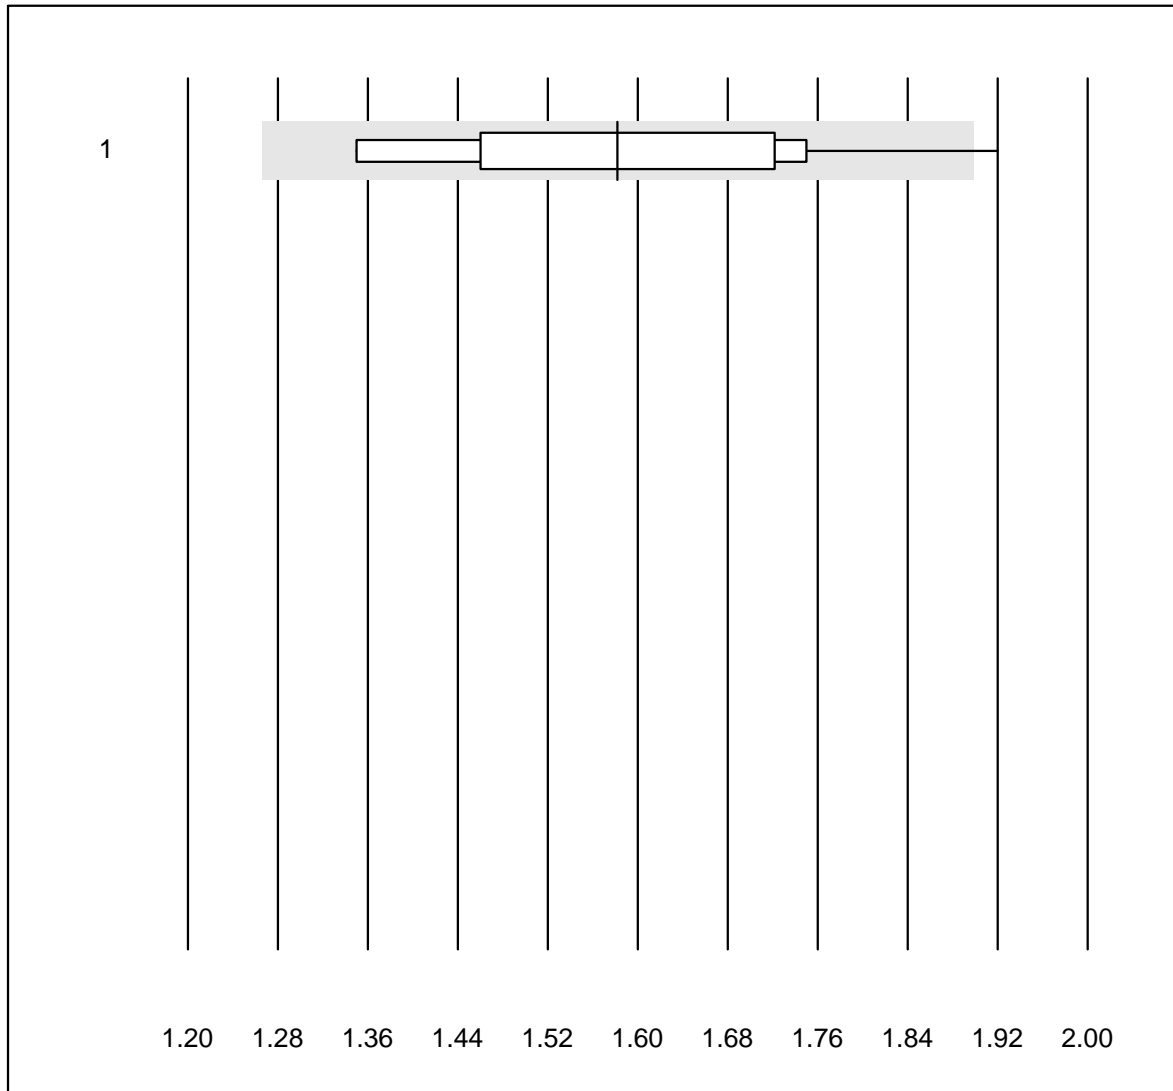


Tolérance QUALAB : 20 %

Triglyceride PTS (mmol/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 CardioChek	10	90.0	10.0	0.0	1.58	10.9	e*

Procalcitonine

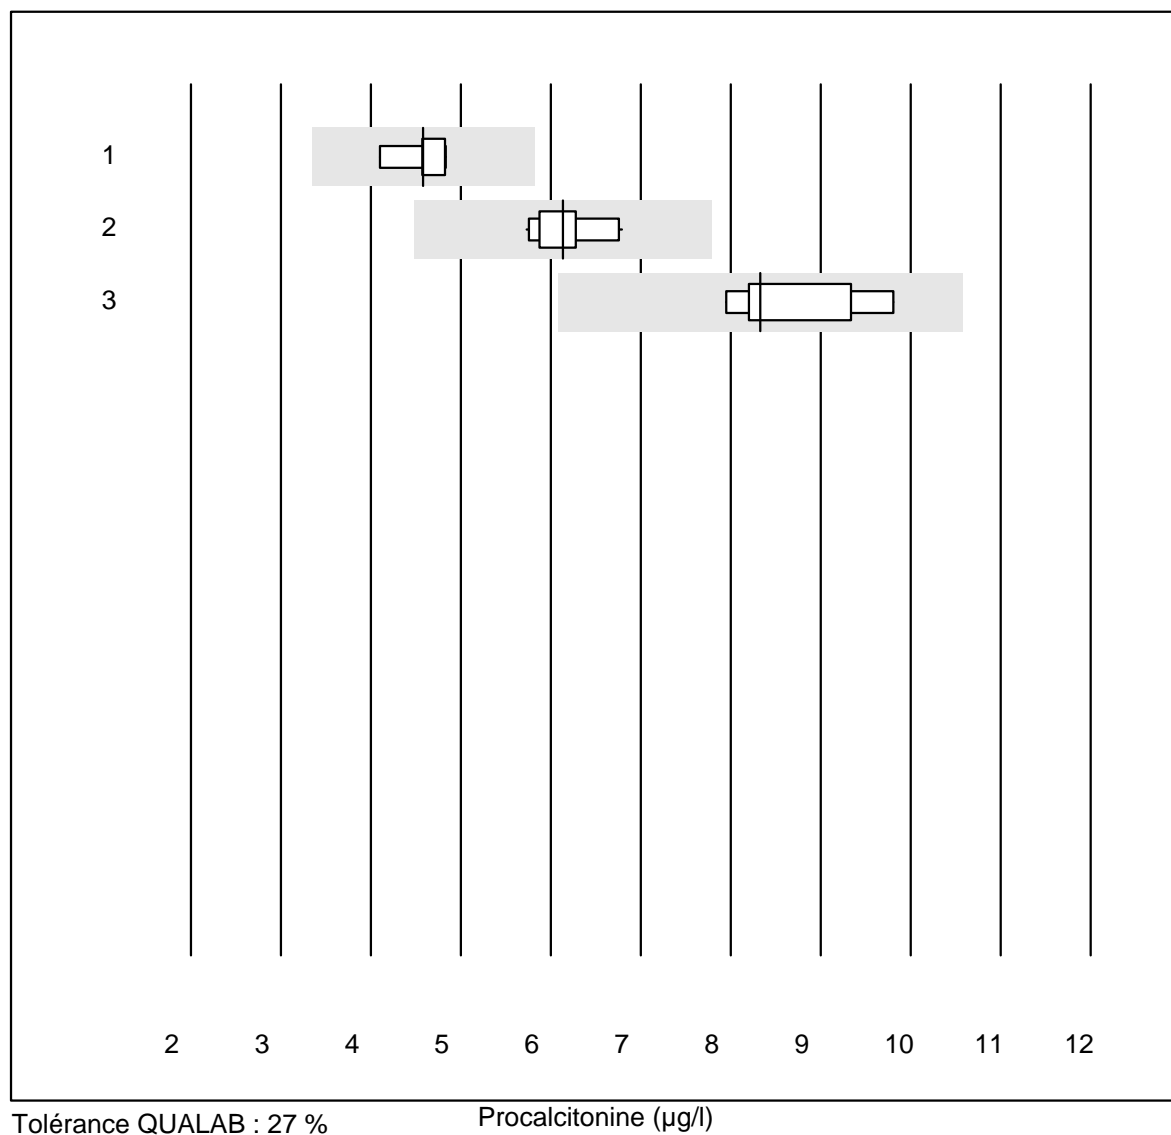

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	4.58	6.5	e
2 VIDAS	19	100.0	0.0	0.0	6.13	5.7	e
3 Liason	6	100.0	0.0	0.0	8.33	8.6	e*

Parathormone

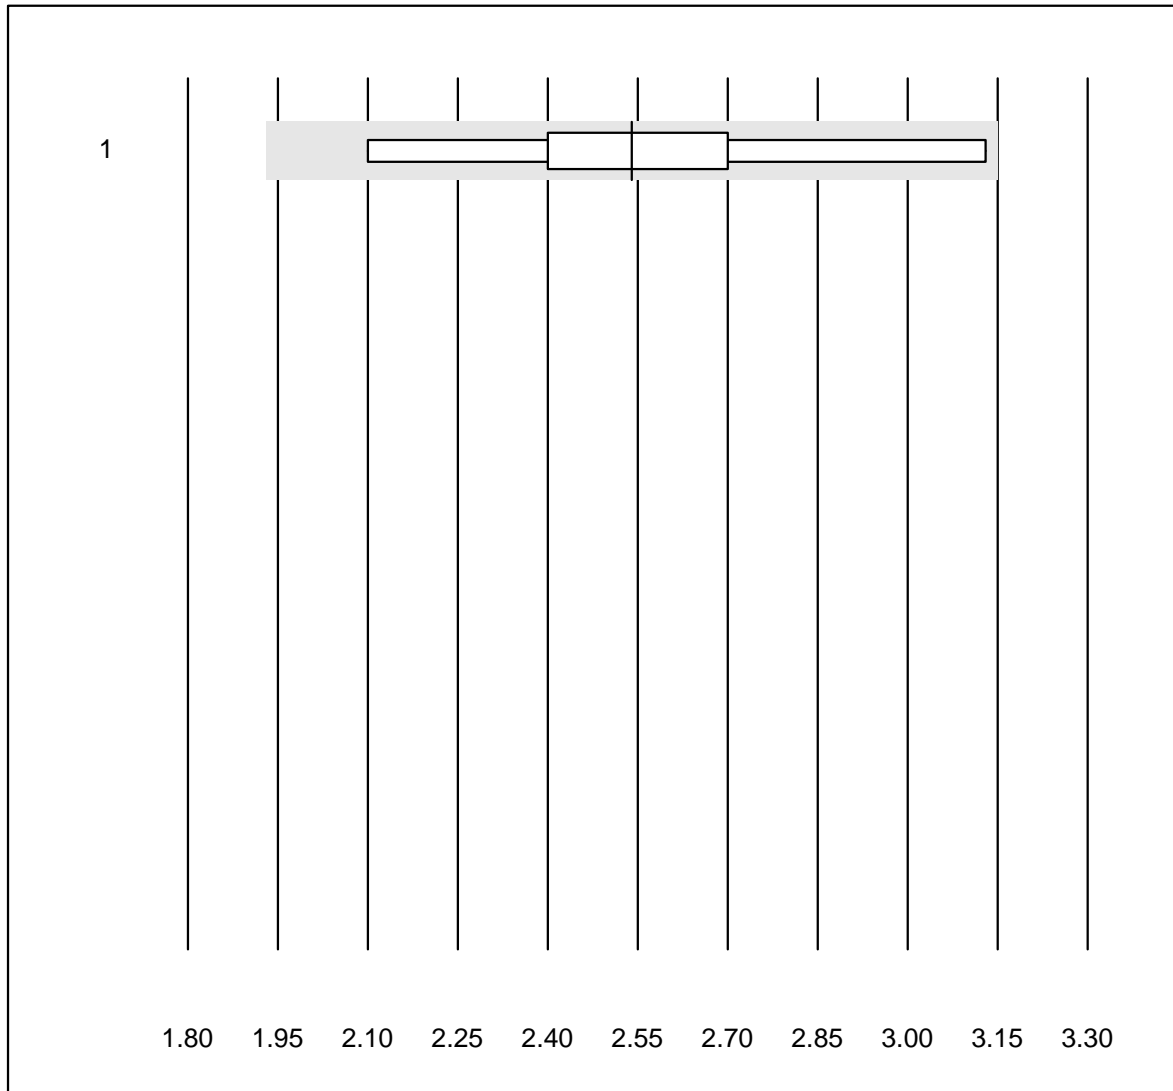


Tolérance QUALAB : 24 %

Parathormone (pmol/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas PTH STAT	6	100.0	0.0	0.0	2.5	13.3	e*

25-OH Vitamin D

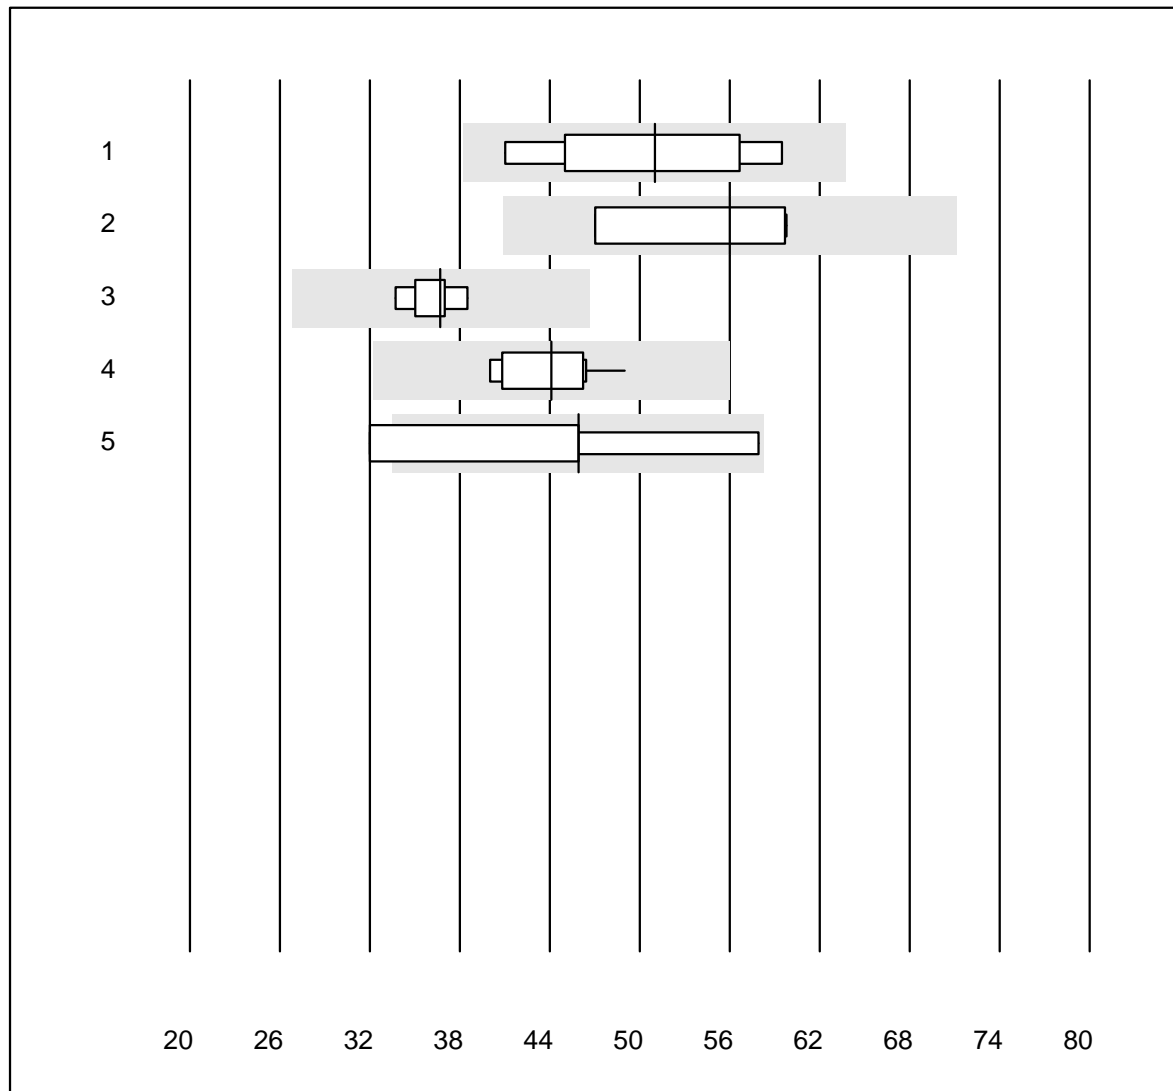


Tolérance QUALAB : 27 %

25-OH Vitamin D (nmol/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Autres méthodes	5	100.0	0.0	0.0	51.0	15.4	a
2 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	56.0	11.4	e*
3 VIDAS	6	83.3	0.0	16.7	36.7	5.1	e
4 Architect	11	100.0	0.0	0.0	44.1	6.7	e
5 Qualigen	5	40.0	40.0	20.0	45.9	29.6	e*

Osmolalité

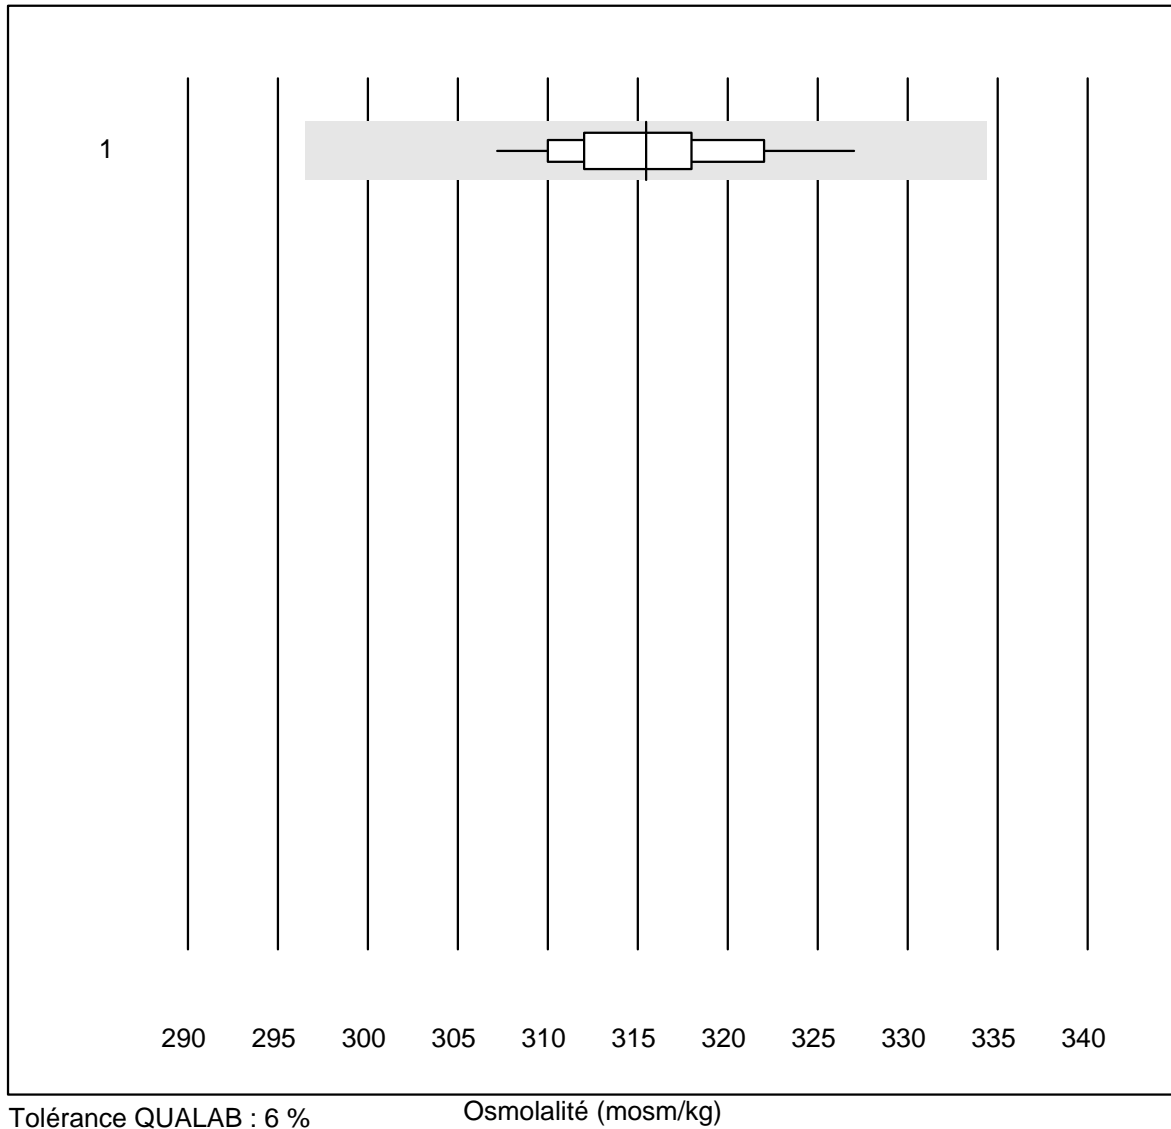


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cryoscopie	14	100.0	0.0	0.0	315	1.7	e

Kalium - K22

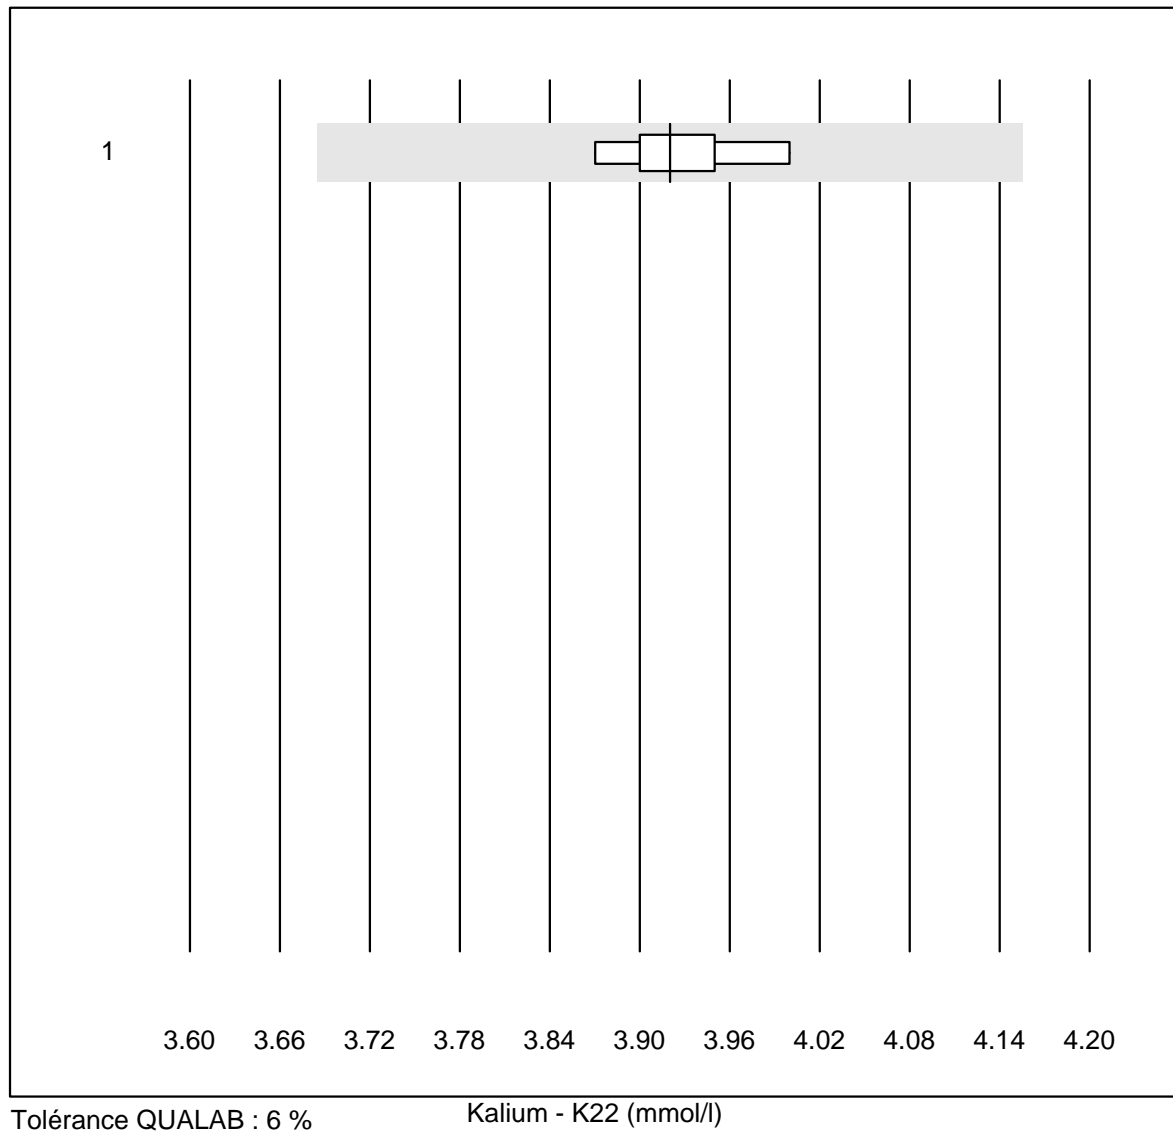

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ISE	9	88.9	0.0	11.1	3.9	1.2	e

Natrium - K22

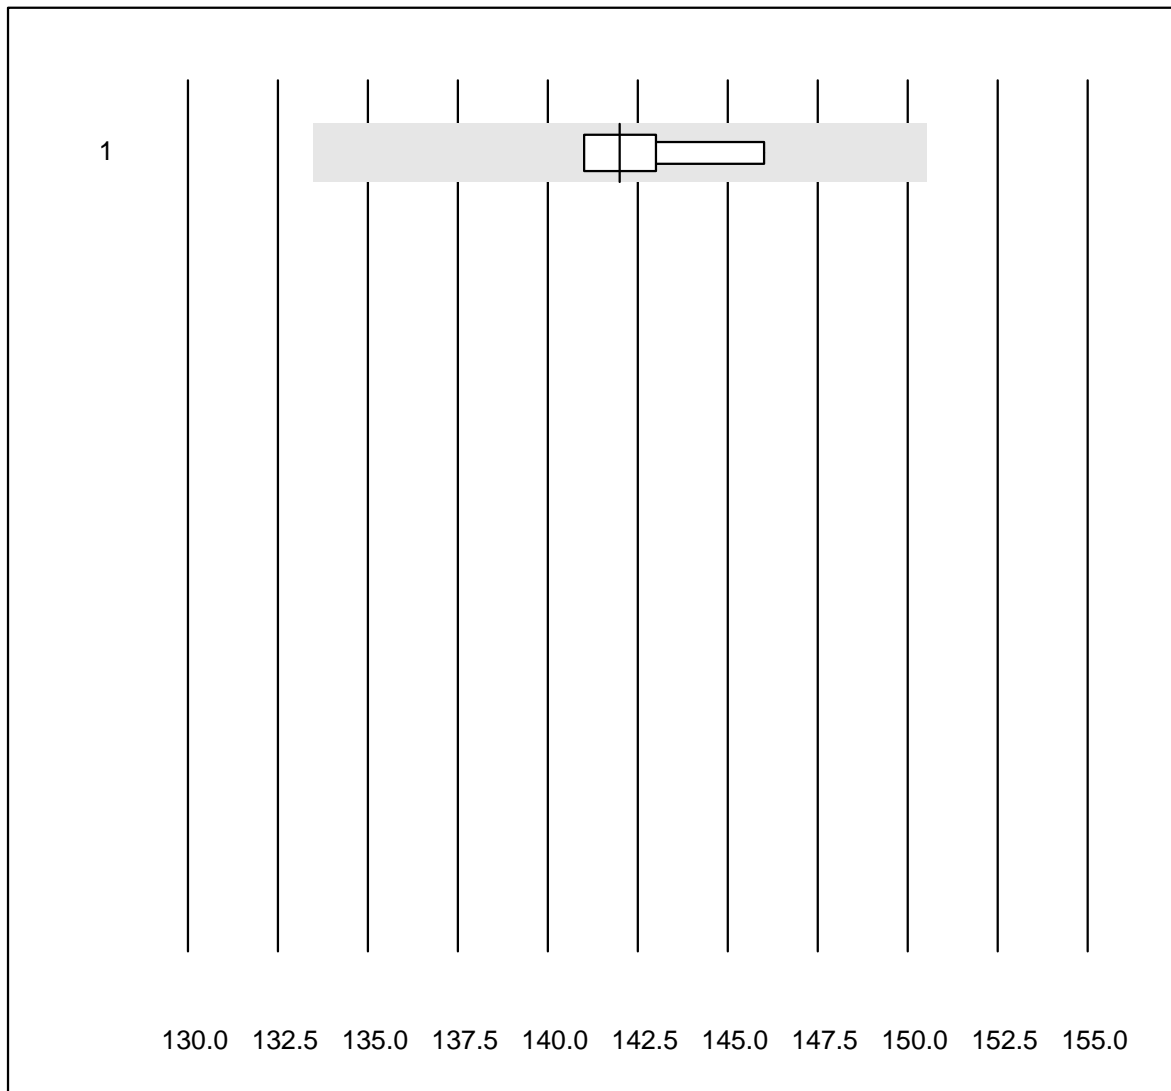


Tolérance QUALAB : 6 %

Natrium - K22 (mmol/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ISE	9	100.0	0.0	0.0	142	1.1	e

Glukose - K22

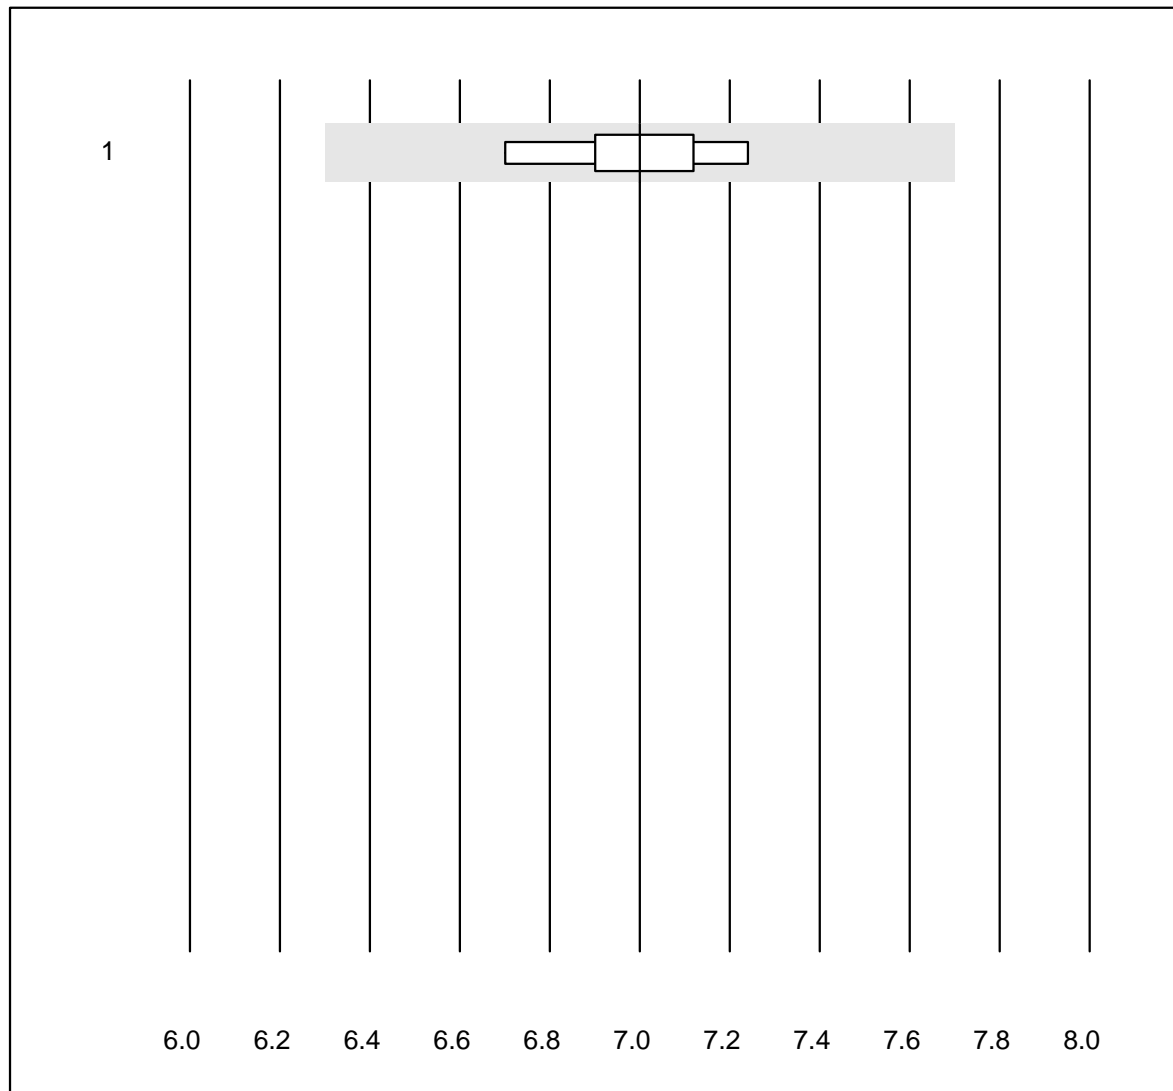


Tolérance QUALAB : 10 %

Glukose - K22 (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	9	100.0	0.0	0.0	7.0	2.6	e

Harnstoff - K22

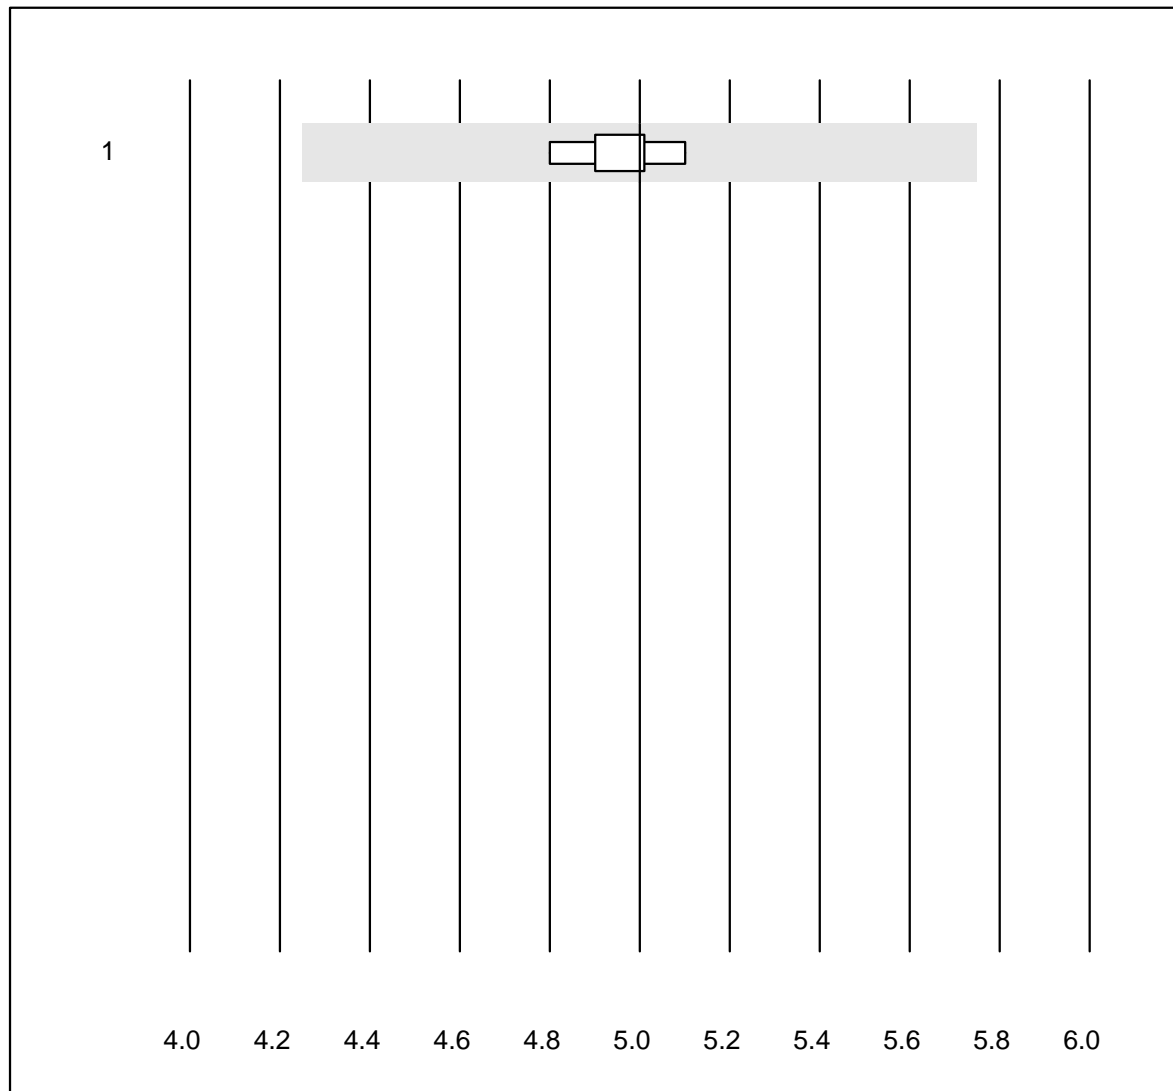


Tolérance QUALAB : 15 %

Harnstoff - K22 (mmol/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Chimie humide	9	88.9	0.0	11.1	5.0	2.0	e

Osmotische Lücke

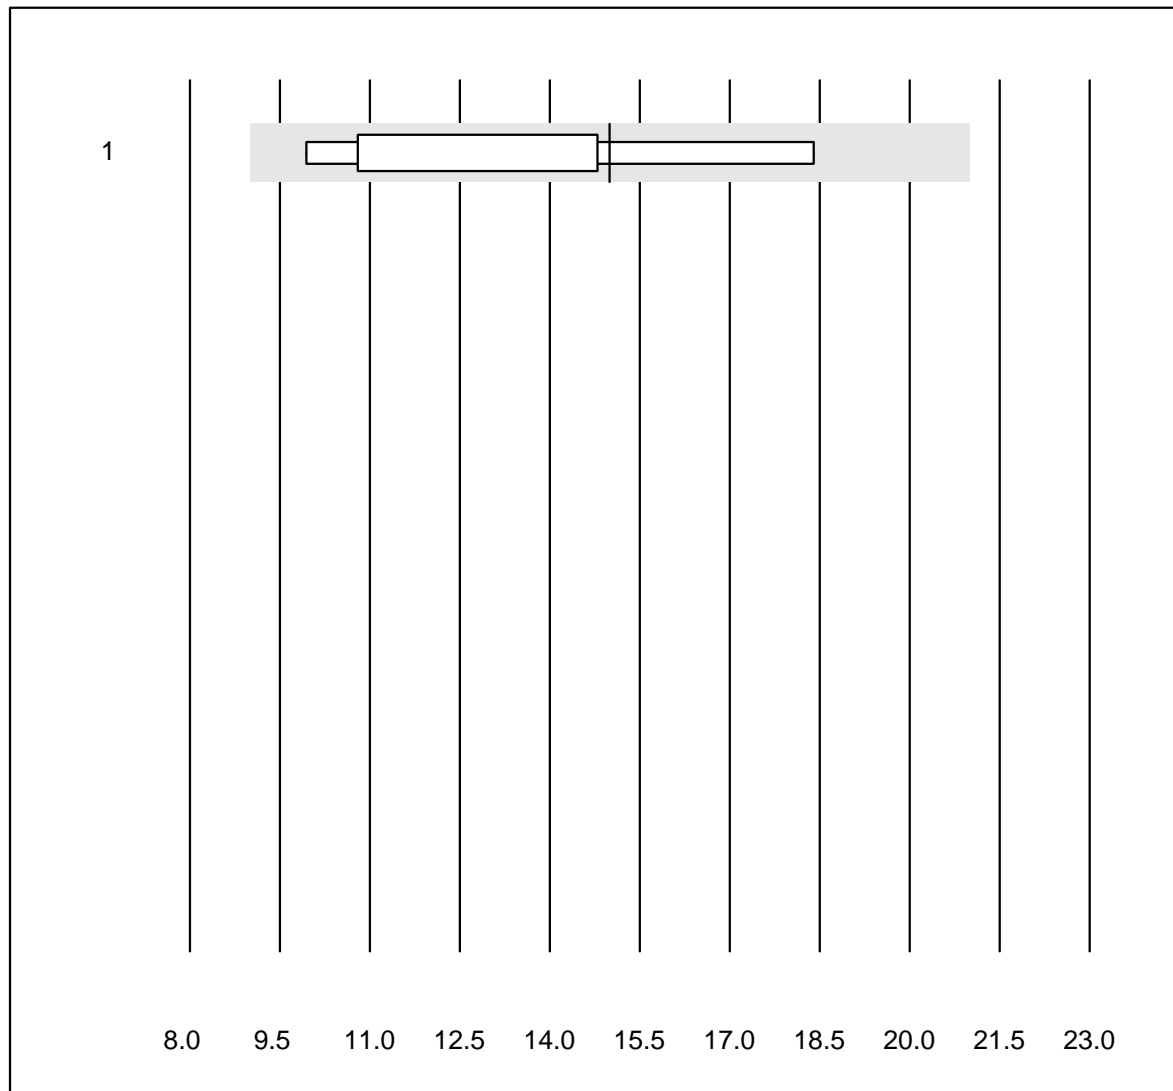


Tolérance QUALAB : 20 %

Osmotische Lücke (mmol/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Formel 1 (2Na+K+Glu+	7	85.7	0.0	14.3	15.0	22.2	a

Digoxin

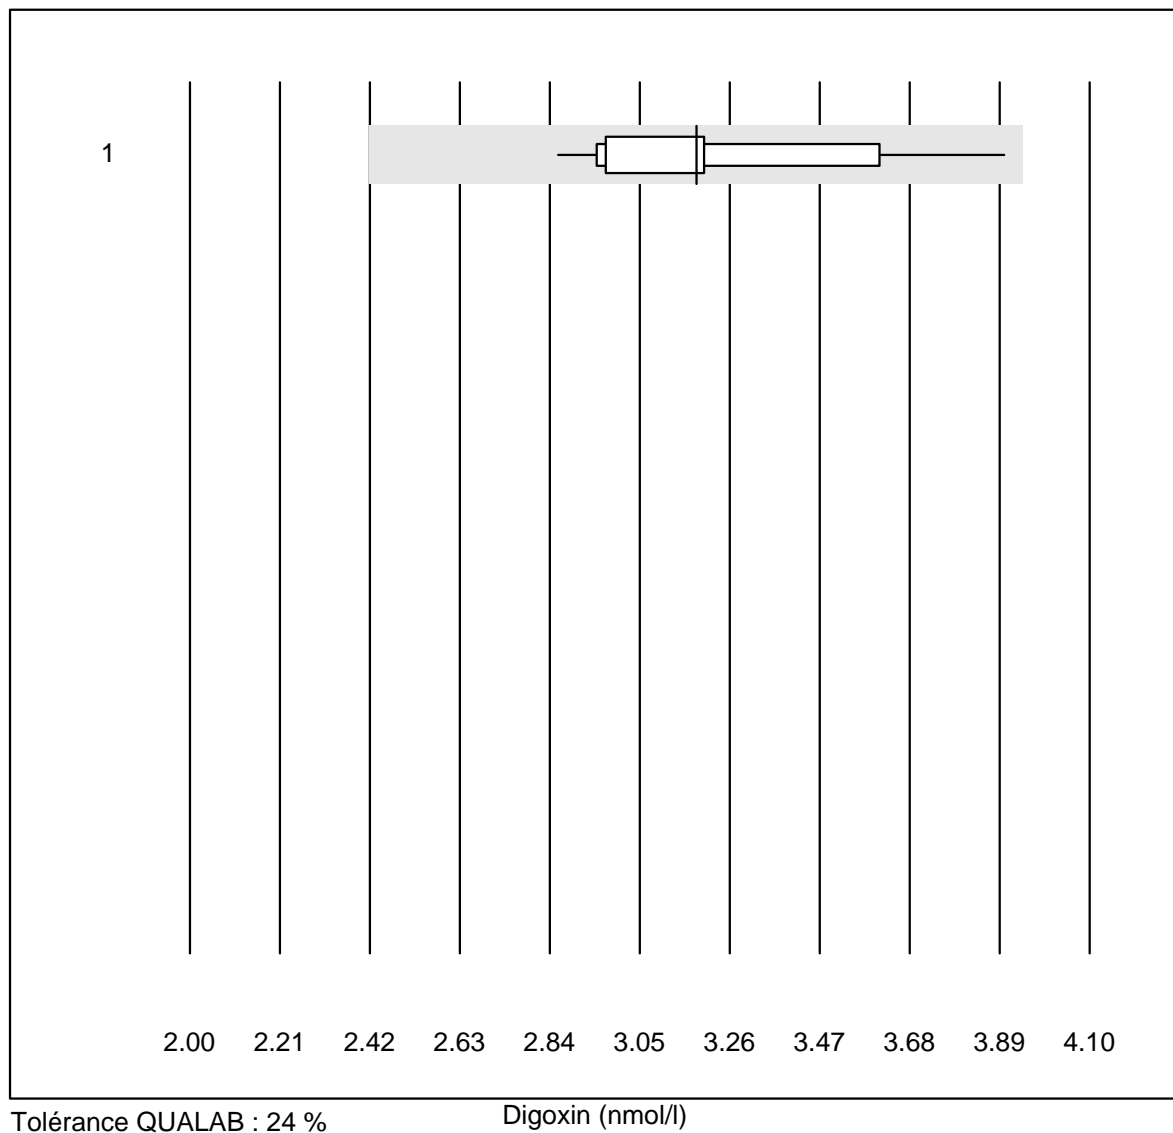

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Autres méthodes	12	100.0	0.0	0.0	3.18	9.4	e

Valproat

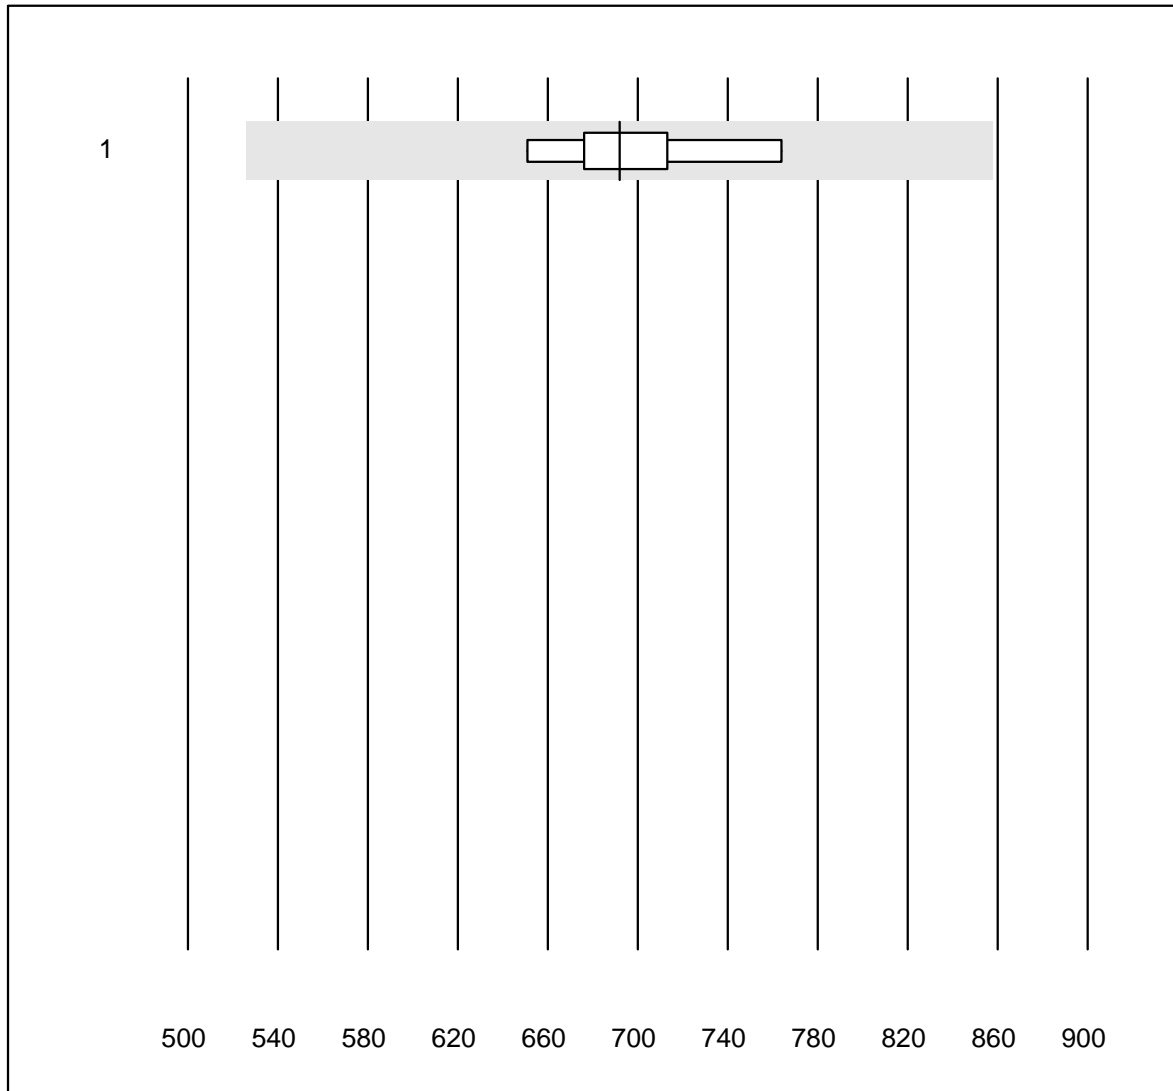


Tolérance QUALAB : 24 %

Valproat (µmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	692.0	6.1	e

Cystatin C

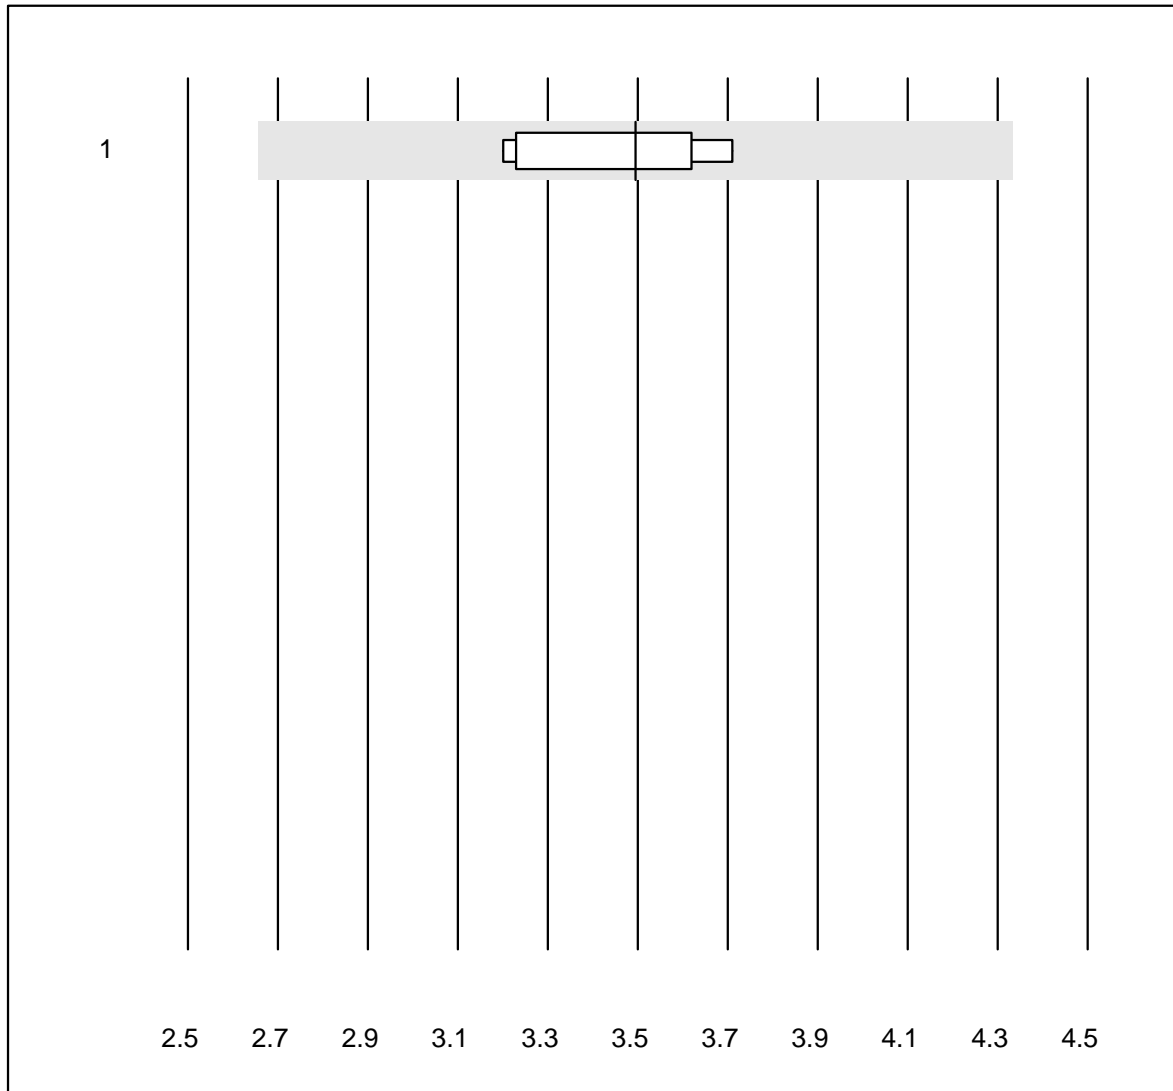


Tolérance QUALAB : 24 %

Cystatin C (mg/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	8	100.0	0.0	0.0	3.5	5.7	e

Alcool

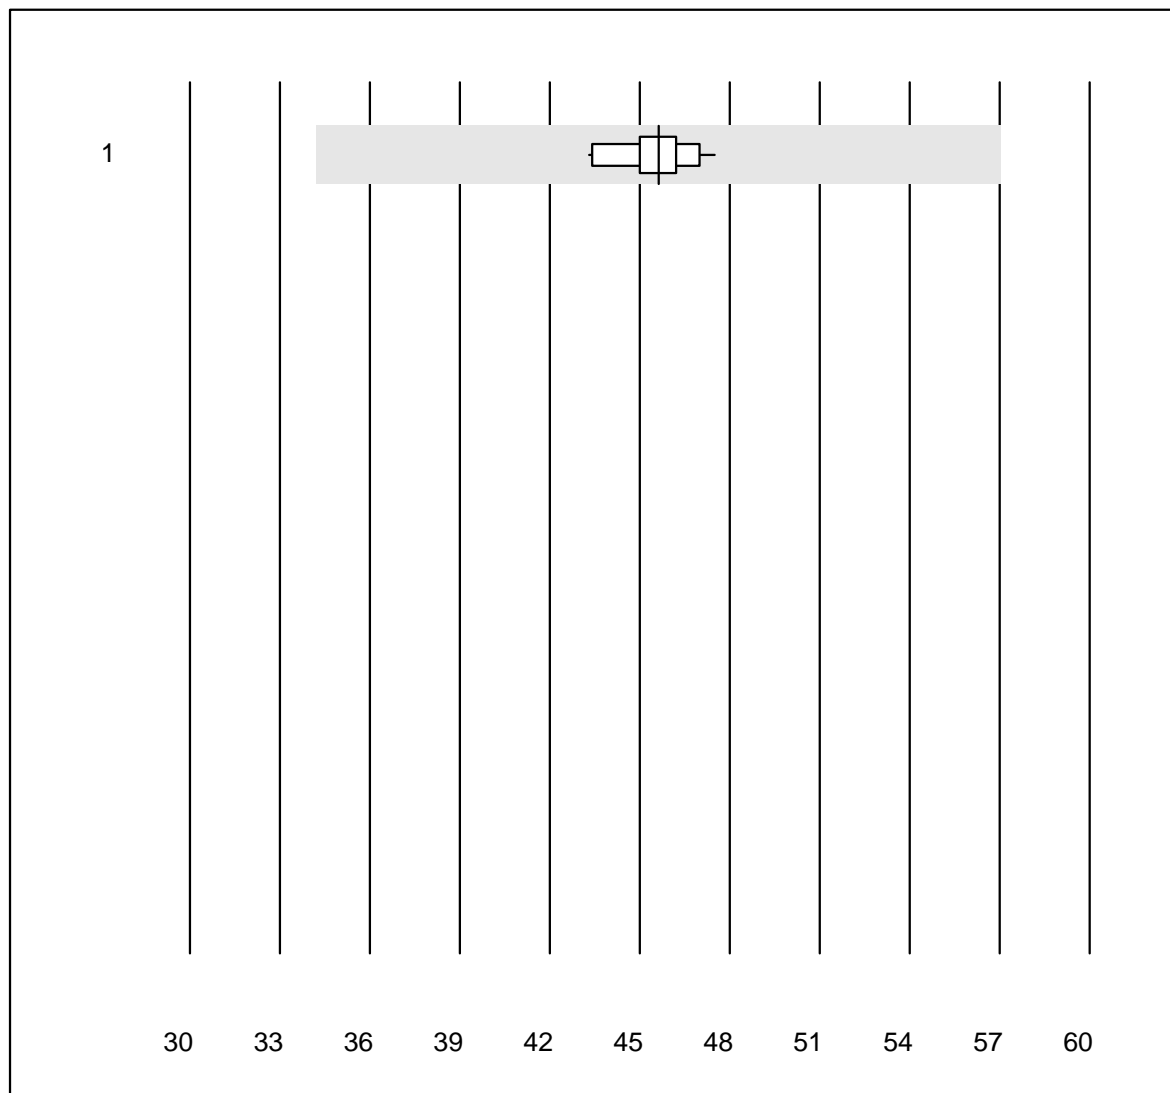


Tolérance QUALAB : 25 %

Alcool (mmol/l)

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	14	100.0	0.0	0.0	45.6	2.6 e

Calprotectin

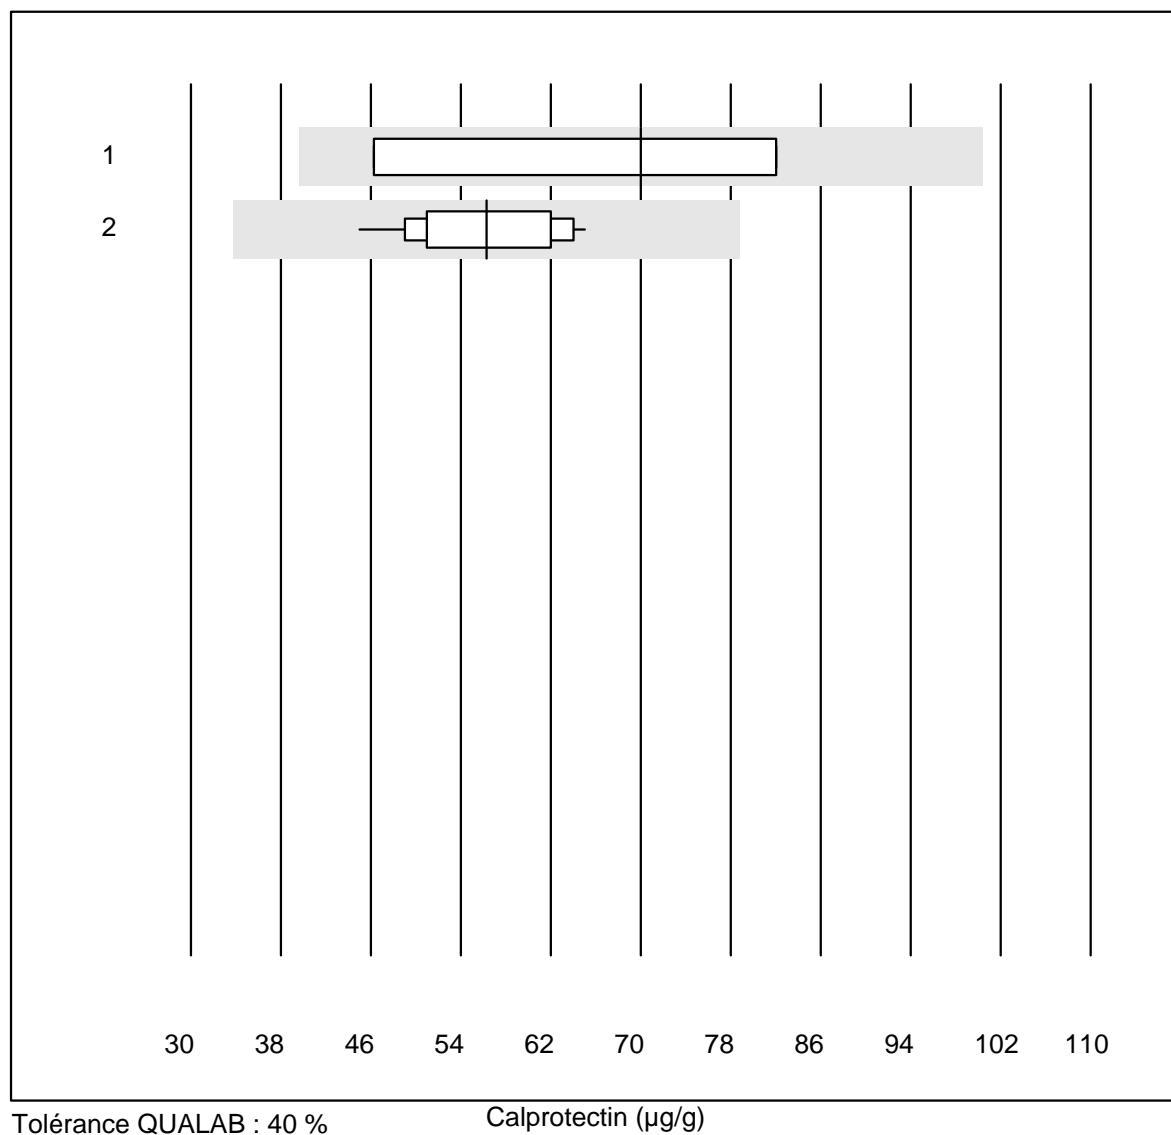


Tolérance QUALAB : 40 %

Calprotectin (µg/g)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Autres méthodes	4	75.0	0.0	25.0	70	27.5	a
2 Bühlmann	11	100.0	0.0	0.0	56	11.2	e

Cholestérol Af/b101

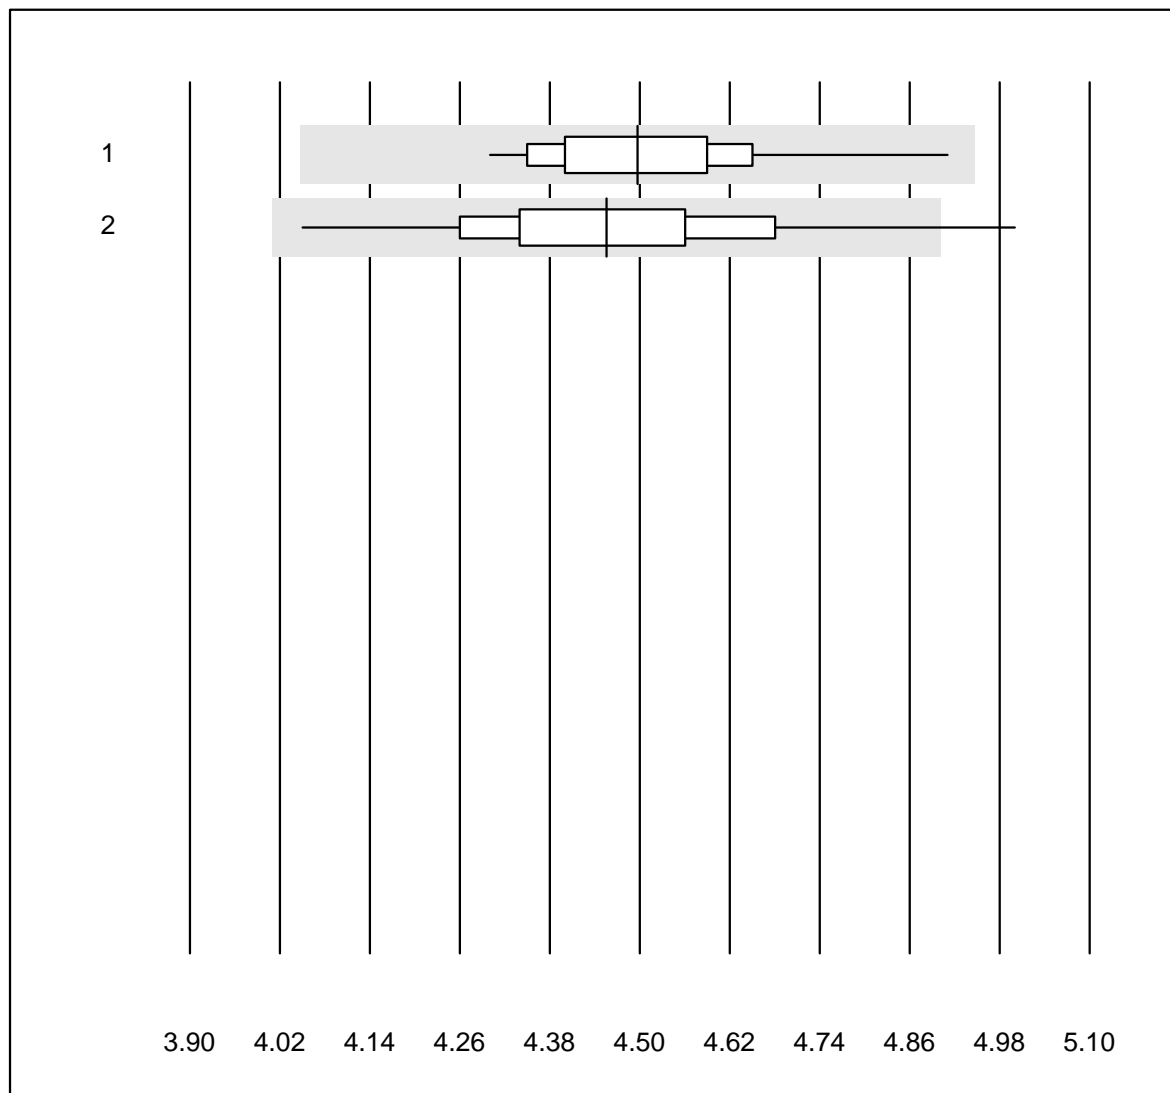


Tolérance QUALAB : 10 %

Cholestérol Af/b101 (mmol/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas b101	52	96.2	0.0	3.8	4.50	2.8	e
2 Afinion	319	99.1	0.6	0.3	4.46	3.7	e


Cholestérol HDL Af/b101

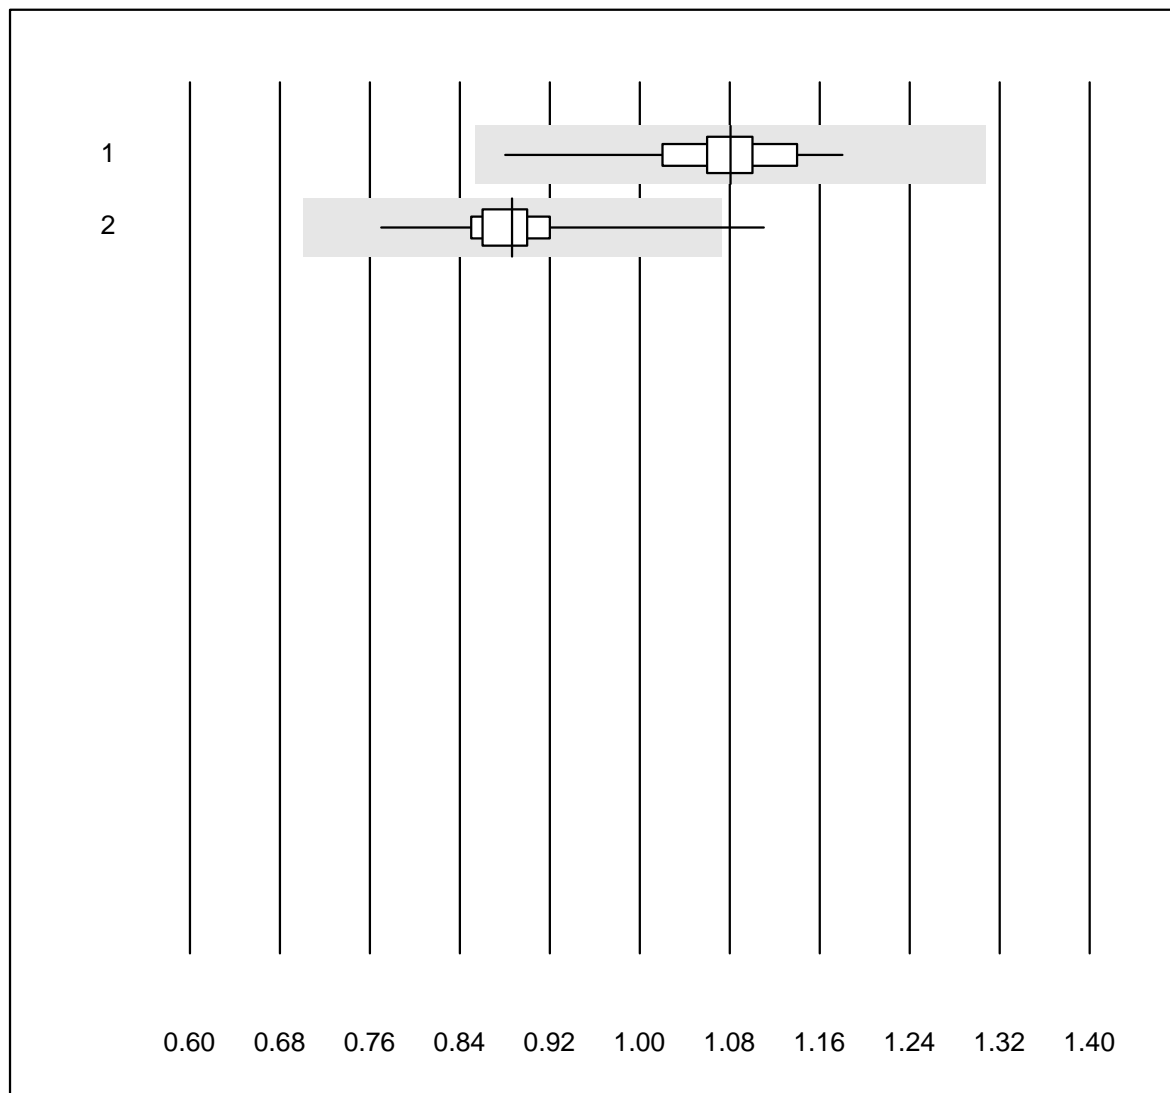

Tolérance QUALAB : 21 % Cholestérol HDL Af/b101 (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas b101	52	92.3	0.0	7.7	1.08	4.6	e
2	Afinion	311	93.9	0.6	5.5	0.89	4.5	e

Triglycerides Af/b101

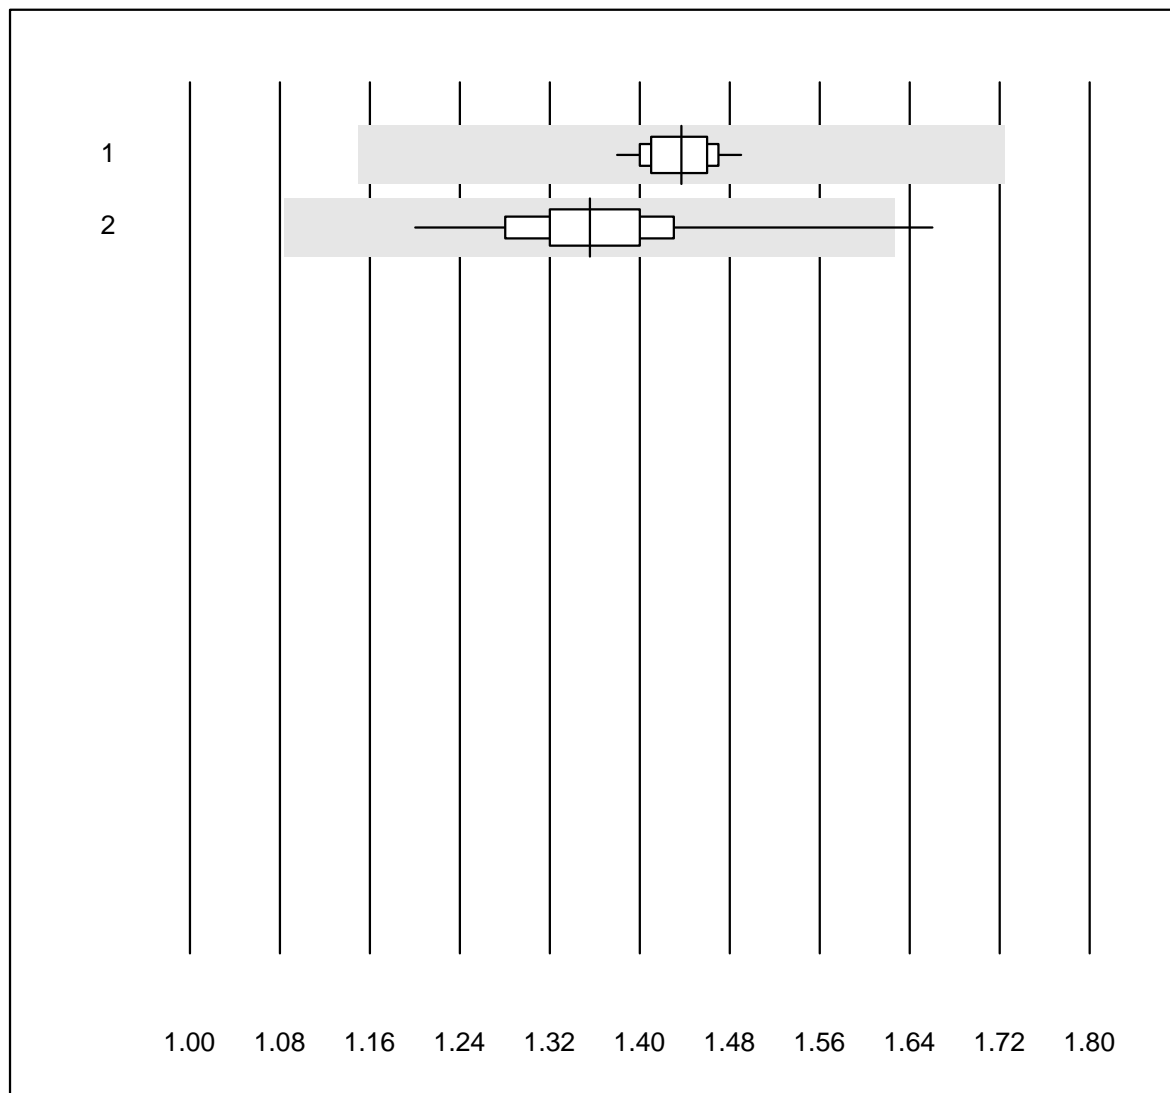


Tolérance QUALAB : 20 %

Triglycerides Af/b101 (mmol/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas b101	50	96.0	0.0	4.0	1.44	2.0	e
2 Afinion	318	99.4	0.6	0.0	1.36	4.9	e

Troponine I S

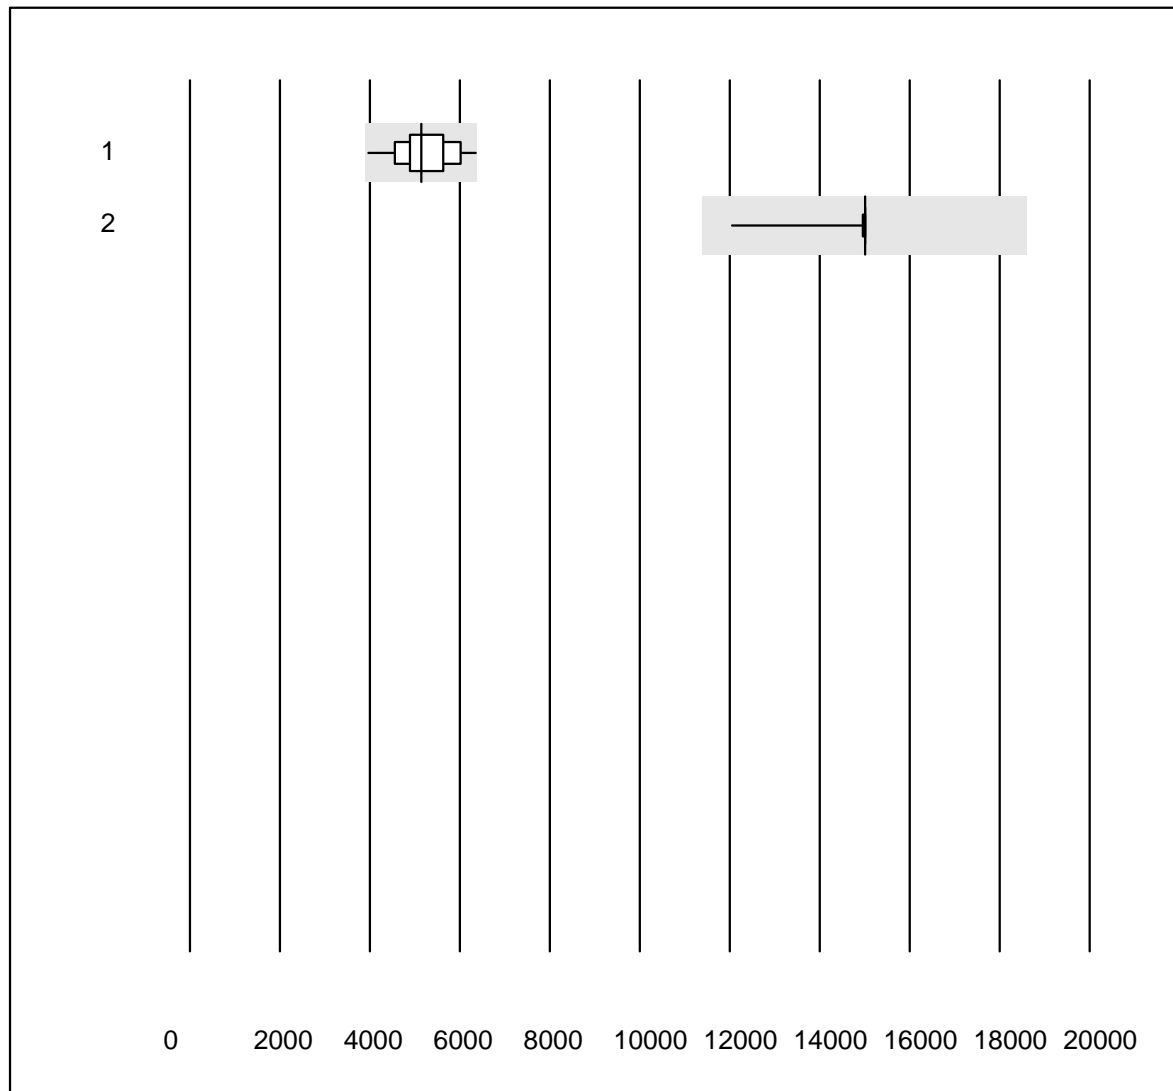


Tolérance QUALAB : 24 %

Troponine I S (ng/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Samsung LABGEO IB10	47	97.9	0.0	2.1	5140.00	10.5	e
2	AFIAS	28	67.9	0.0	32.1	15000.00	4.6	a

D-Dimères qn S

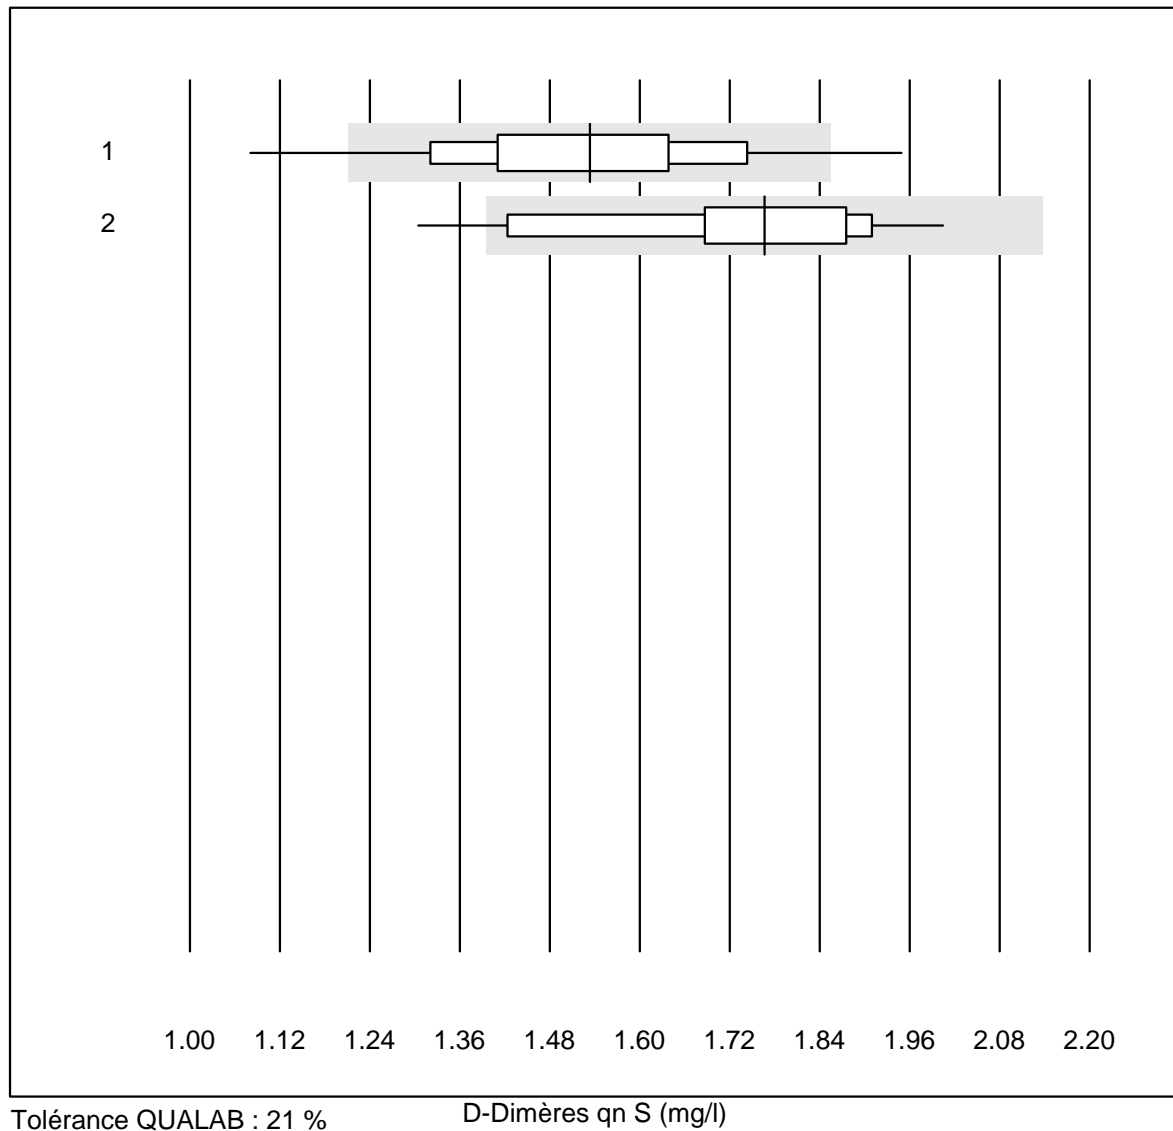

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Samsung LABGEO IB10	61	90.1	6.6	3.3	1.53	10.9	e
2	AFIAS	29	82.8	6.9	10.3	1.77	9.8	e

NT-pro BNP S

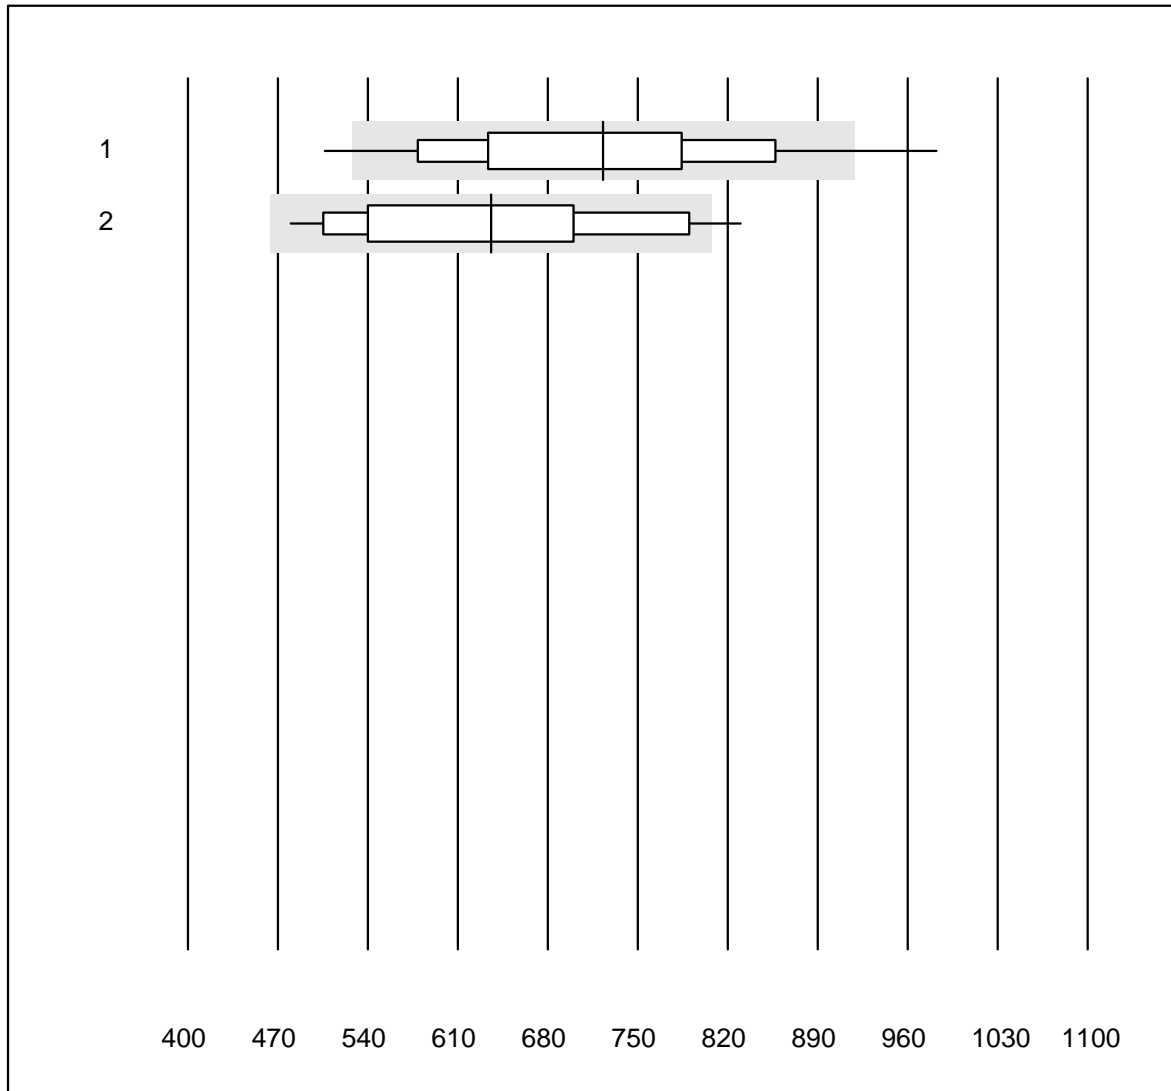


Tolérance QUALAB : 27 %

NT-pro BNP S (ng/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Samsung LABGEO IB10	39	94.9	5.1	0.0	722.9	14.6	e
2	AFIAS	21	80.9	4.8	14.3	635.9	15.6	e*

Homocystein

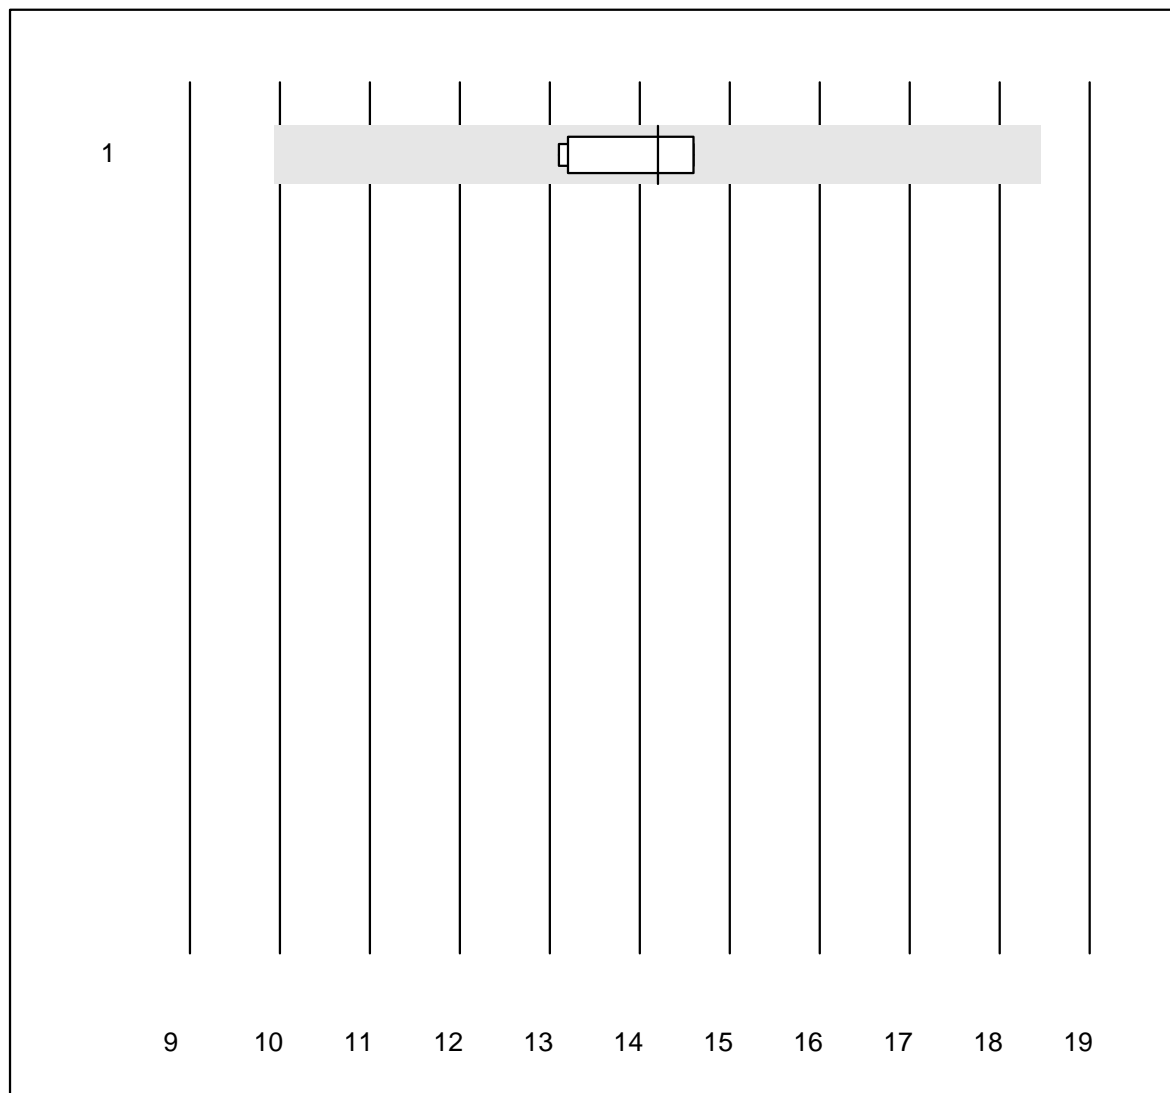


Tolérance QUALAB : 30 %

Homocystein (µmol/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	14.2	5.0	e

Cholinestérase

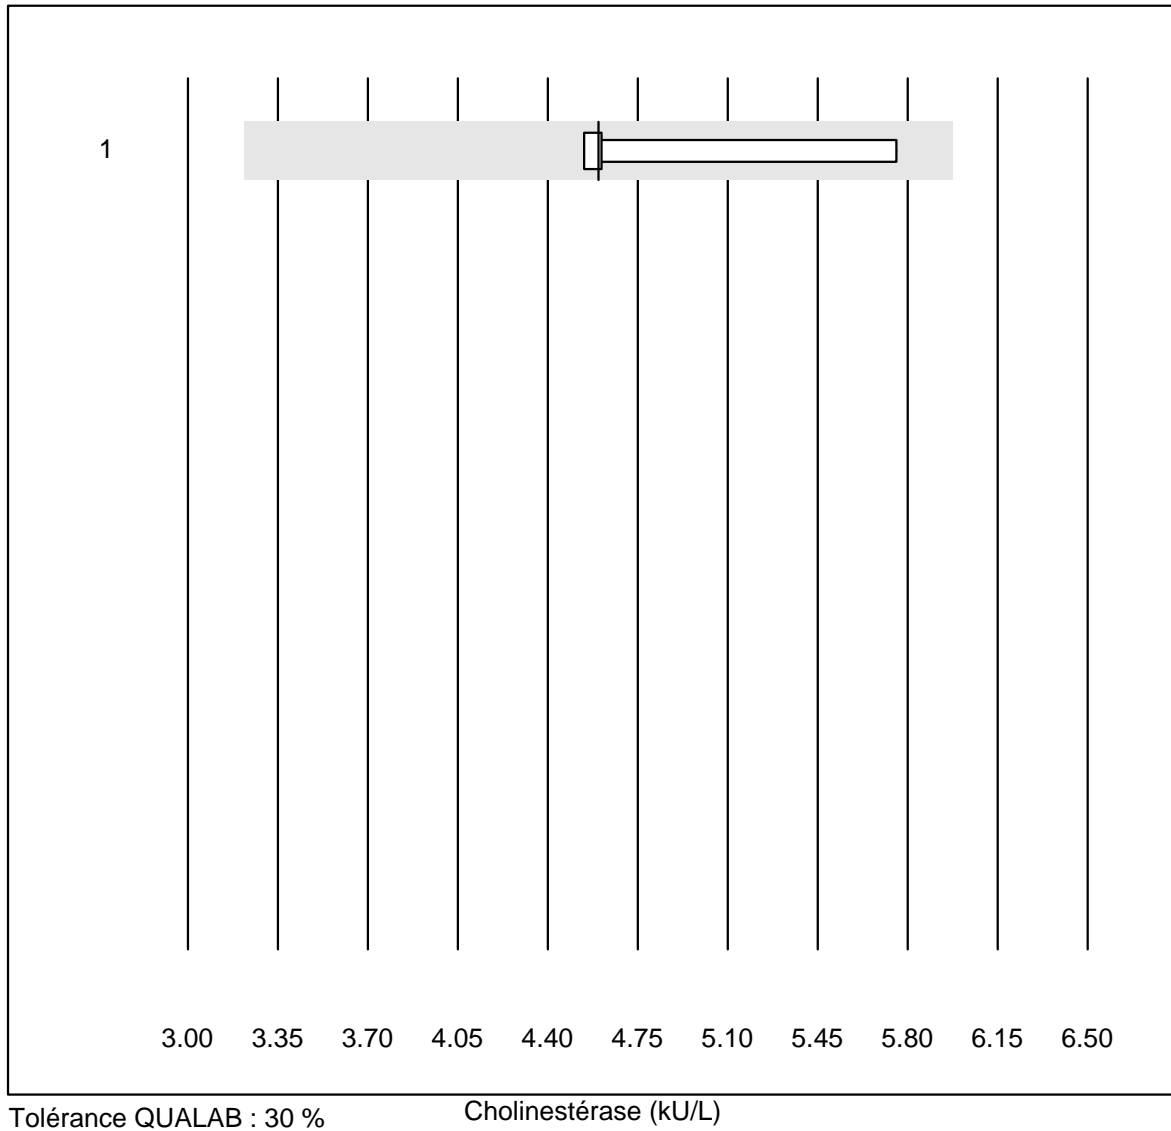

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	4.6	12.1	e*

Lipase

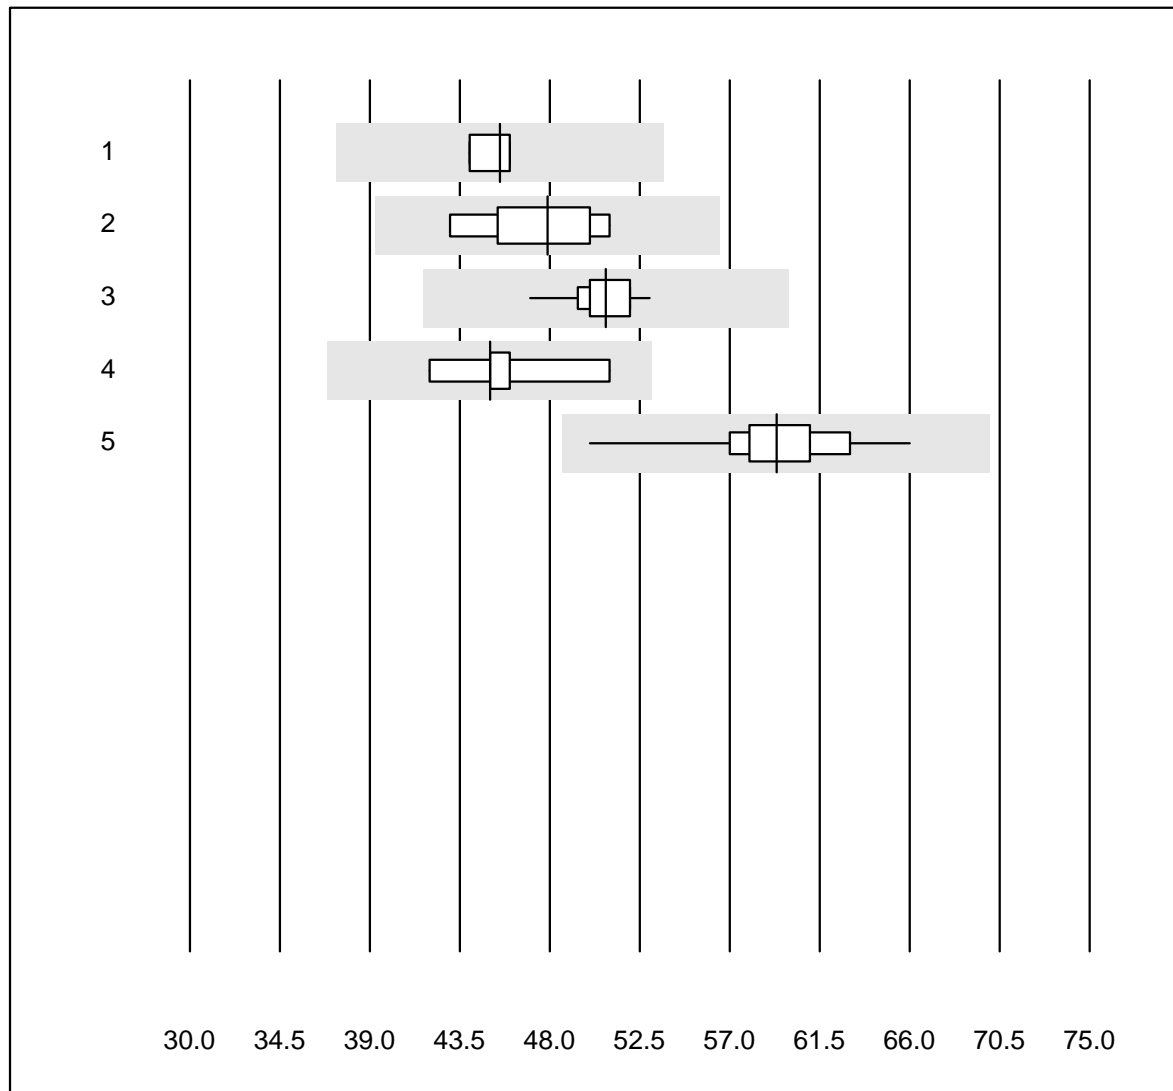


Tolérance QUALAB : 18 %

Lipase (U/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Autolyser/DiaSys	4	100.0	0.0	0.0	45.5	2.1	e
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	47.9	6.9	e*
3 Beckman	13	100.0	0.0	0.0	50.8	3.1	e
4 Cobas	9	100.0	0.0	0.0	45.0	5.9	e
5 Fuji Dri-Chem	102	99.0	0.0	1.0	59.3	4.3	e

Tacrolimus

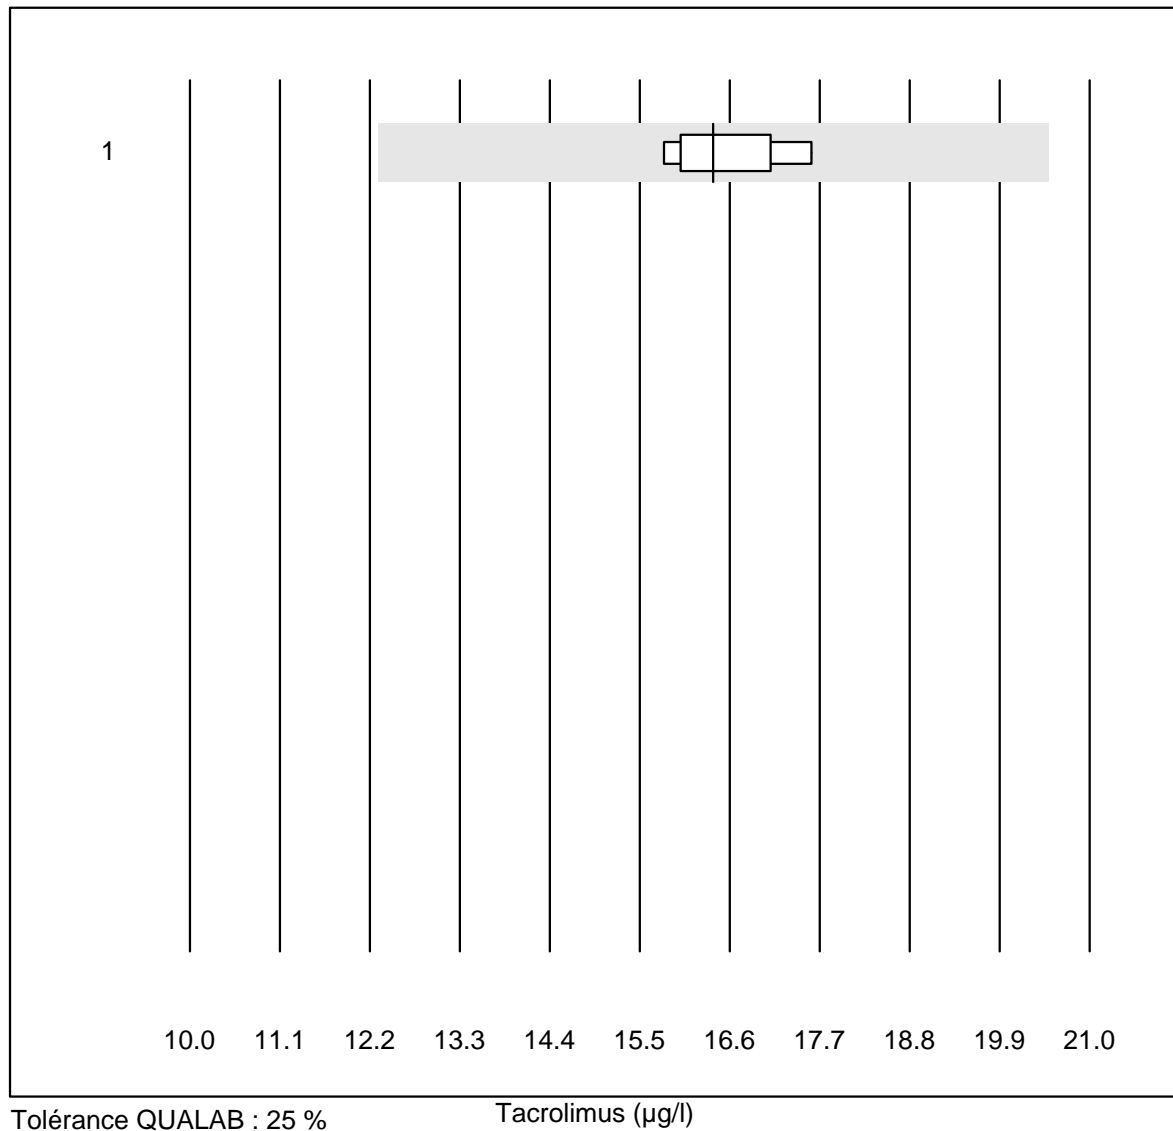

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	16.4	4.6	e

Albumin E

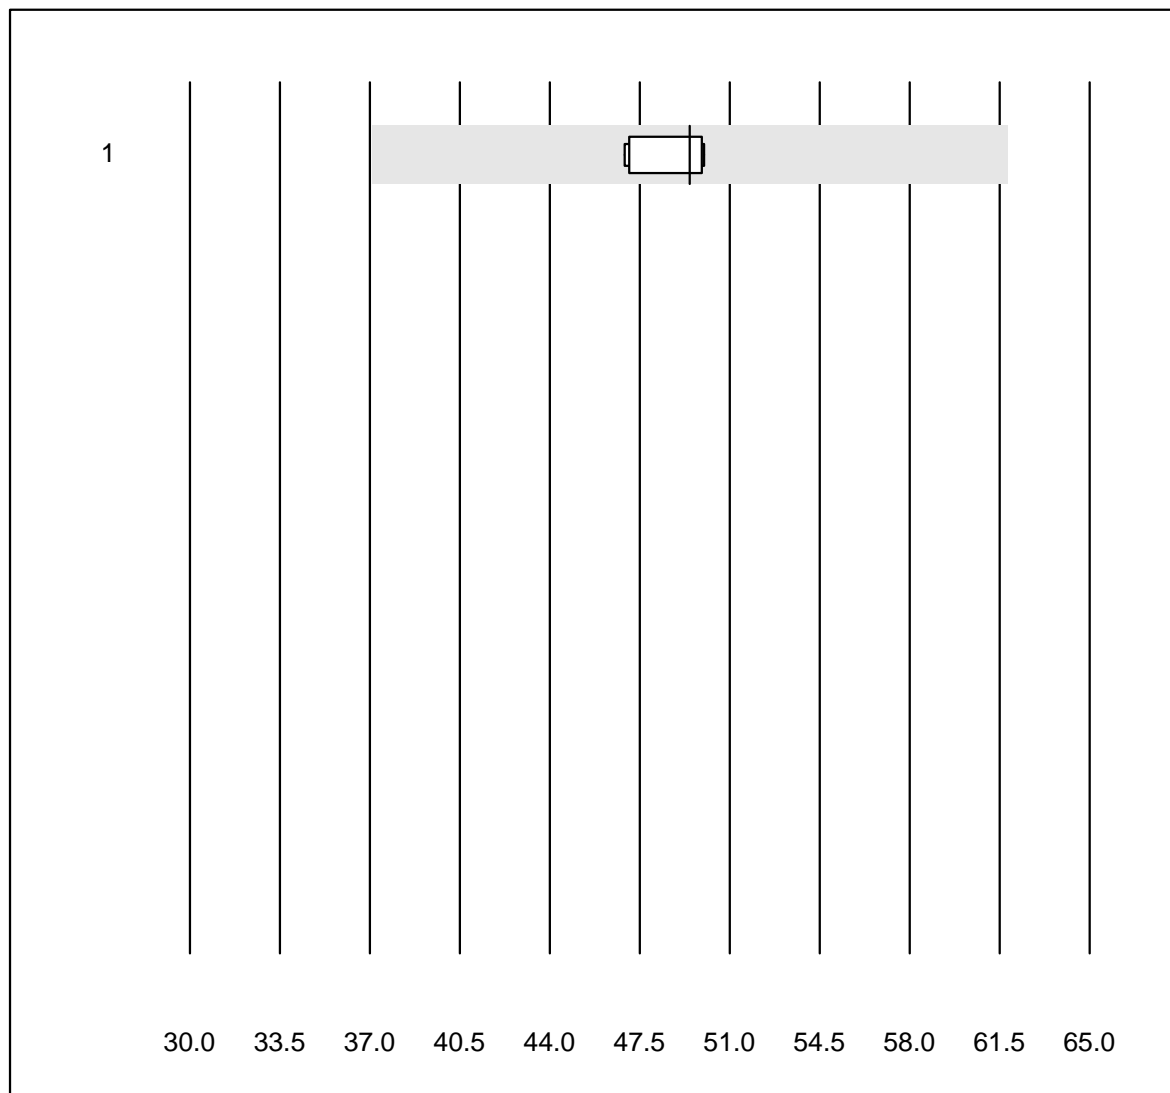


Tolérance QUALAB : 25 %

Albumin E (%)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Elektroforese	6	100.0	0.0	0.0	49.5	2.9	e

alpha-1-Globuline

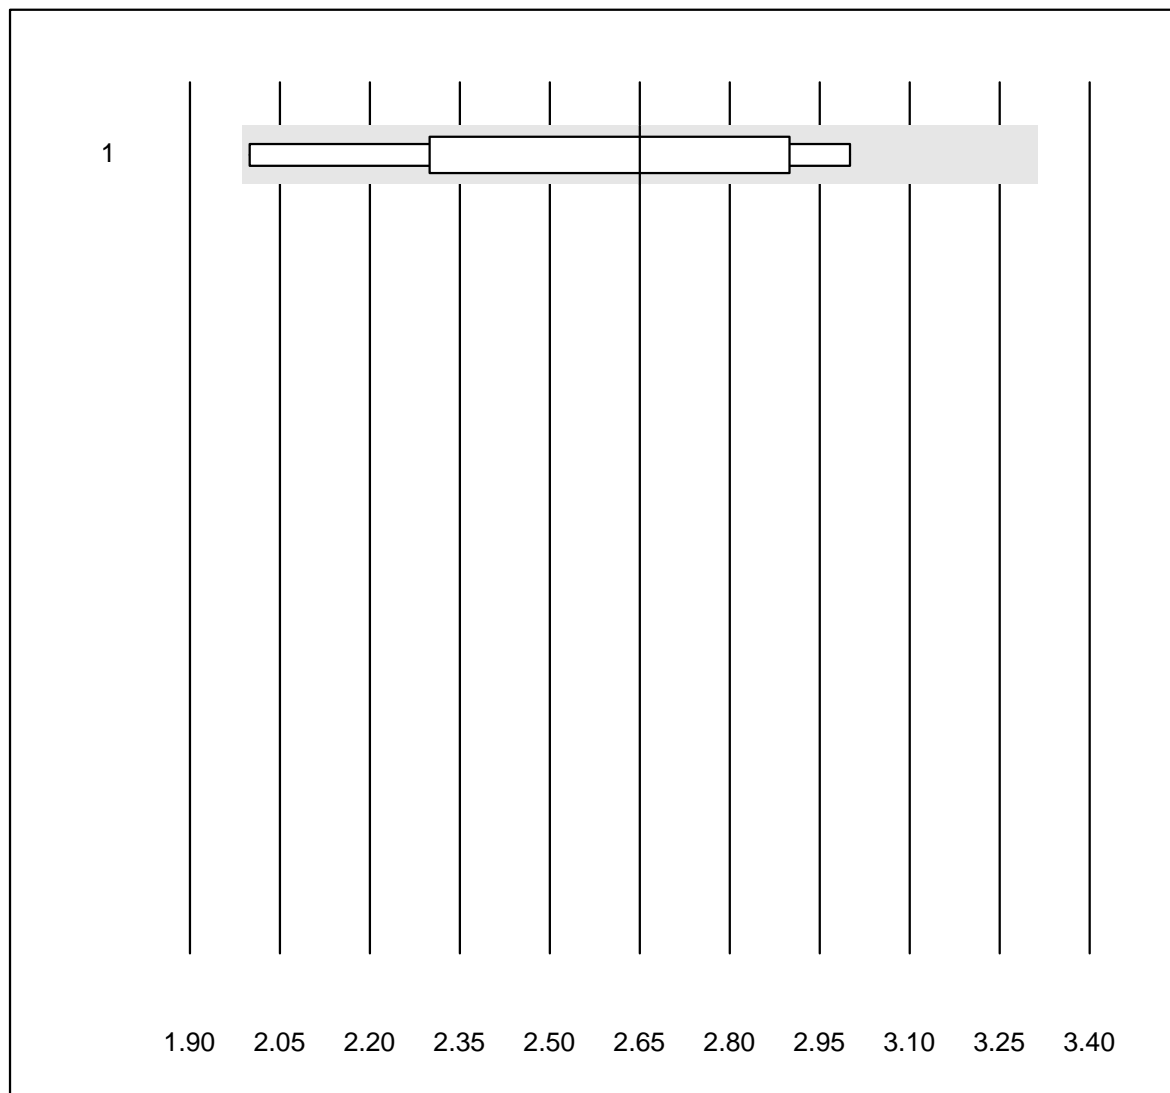


Tolérance QUALAB : 25 %

alpha-1-Globuline (%)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Elektrophorese	6	83.3	0.0	16.7	2.7	16.7	e*

alpha-2-Globuline

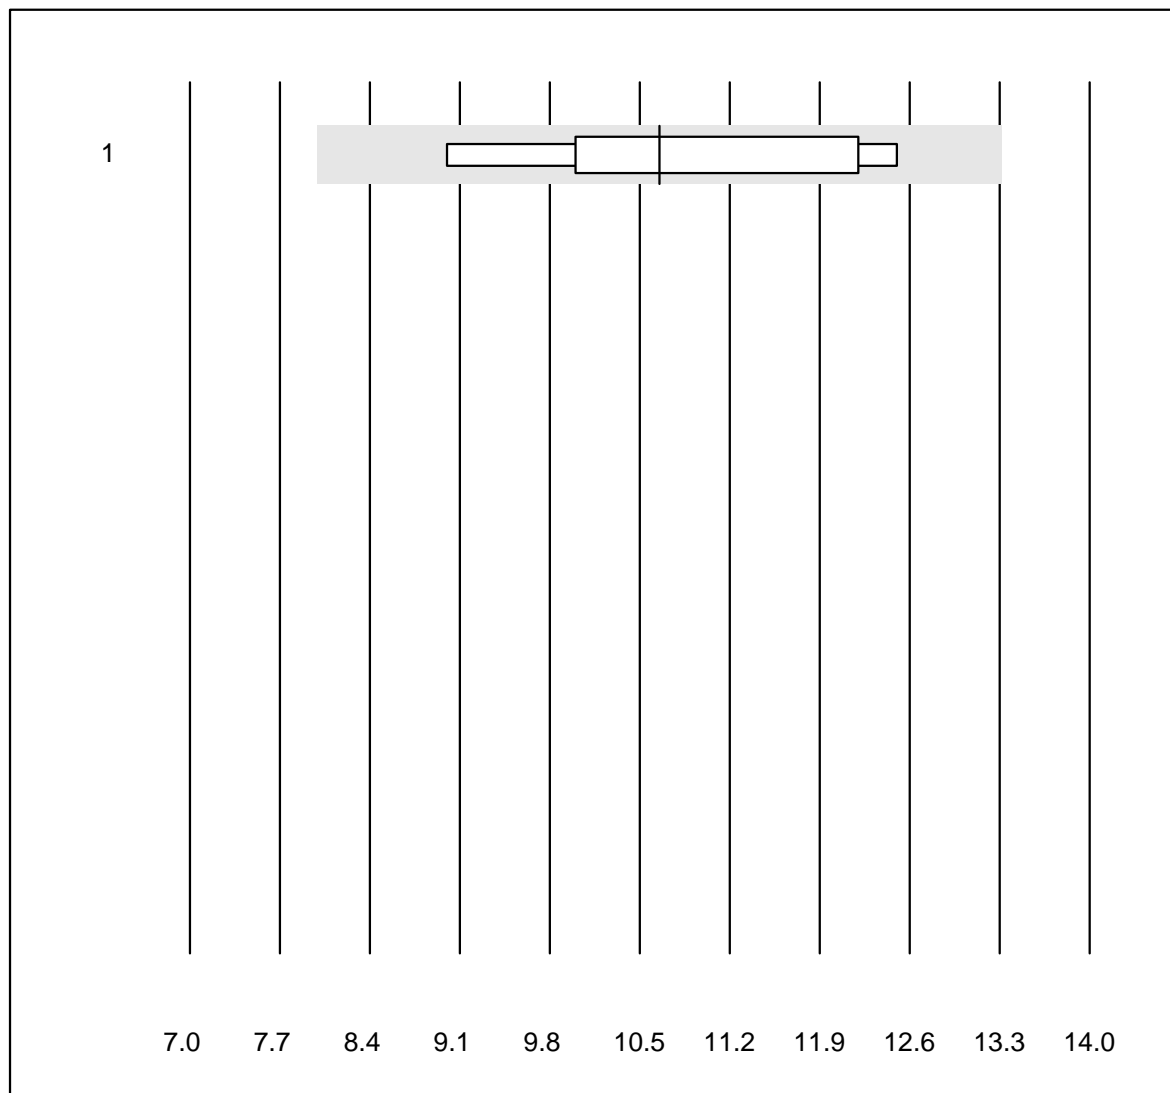


Tolérance QUALAB : 25 %

alpha-2-Globuline (%)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Elektrophorese	6	100.0	0.0	0.0	10.7	12.6	e*

beta-Globuline

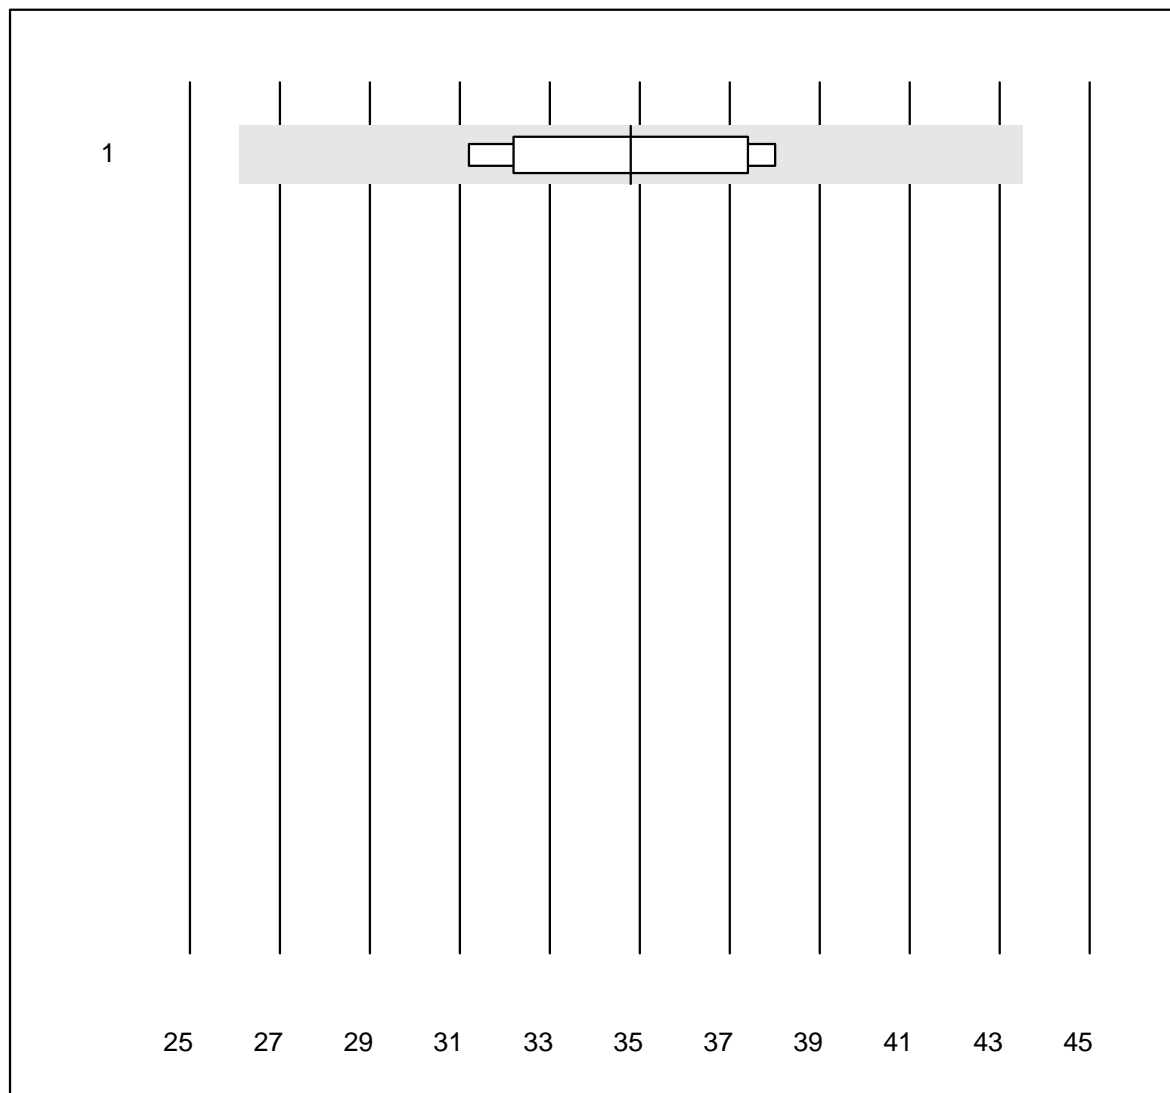


Tolérance QUALAB : 25 %

beta-Globuline (%)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Elektrophorese	6	100.0	0.0	0.0	34.8	8.8	e*

gamma-Globuline

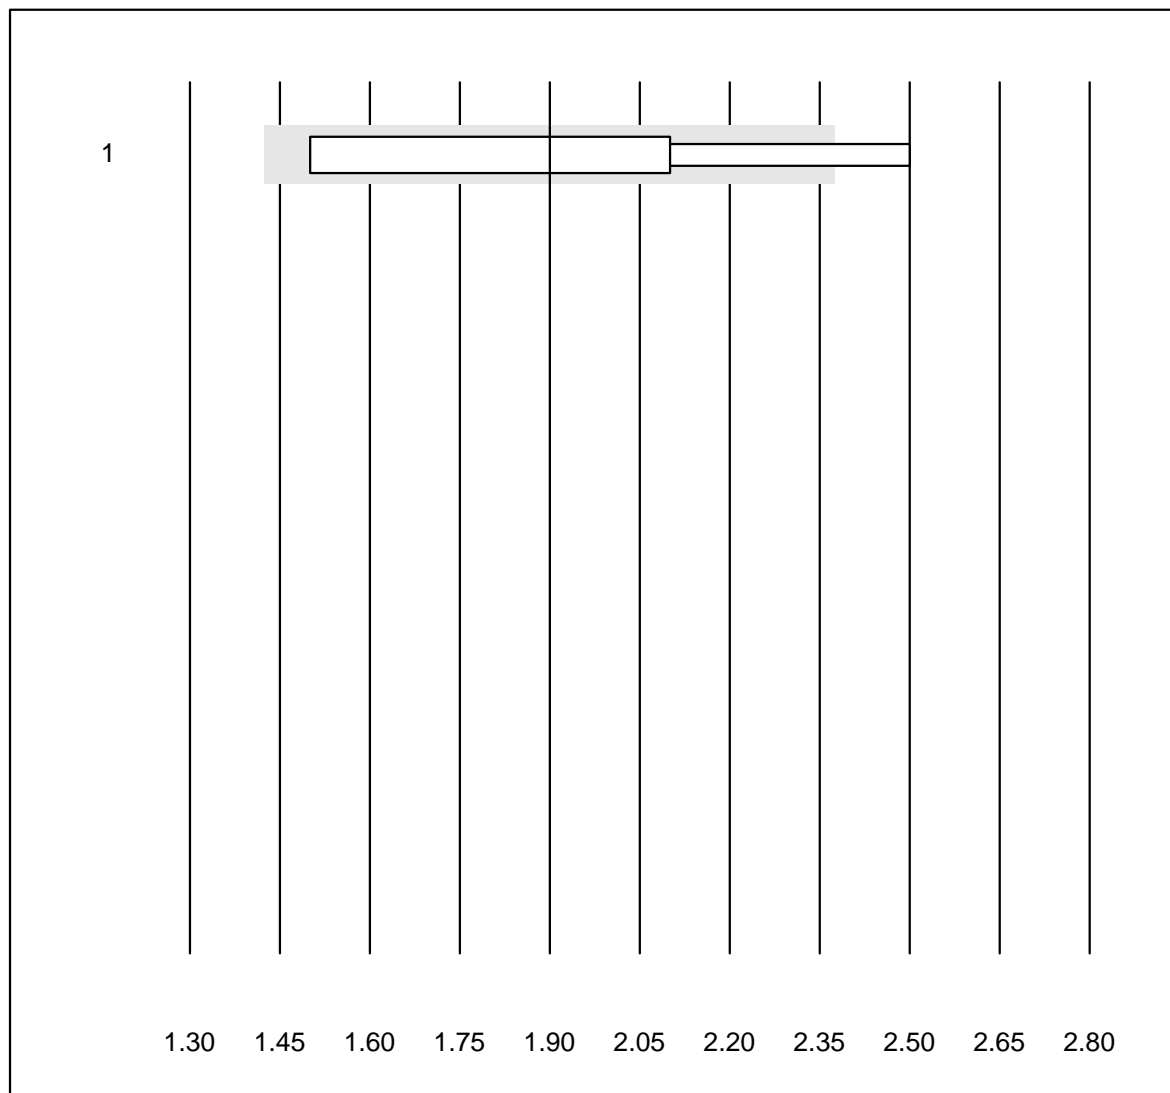


Tolérance QUALAB : 25 %

gamma-Globuline (%)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Elektrophorese	6	50.0	16.7	33.3	1.9	20.3	a


Folates érythrocytaires échantillon A

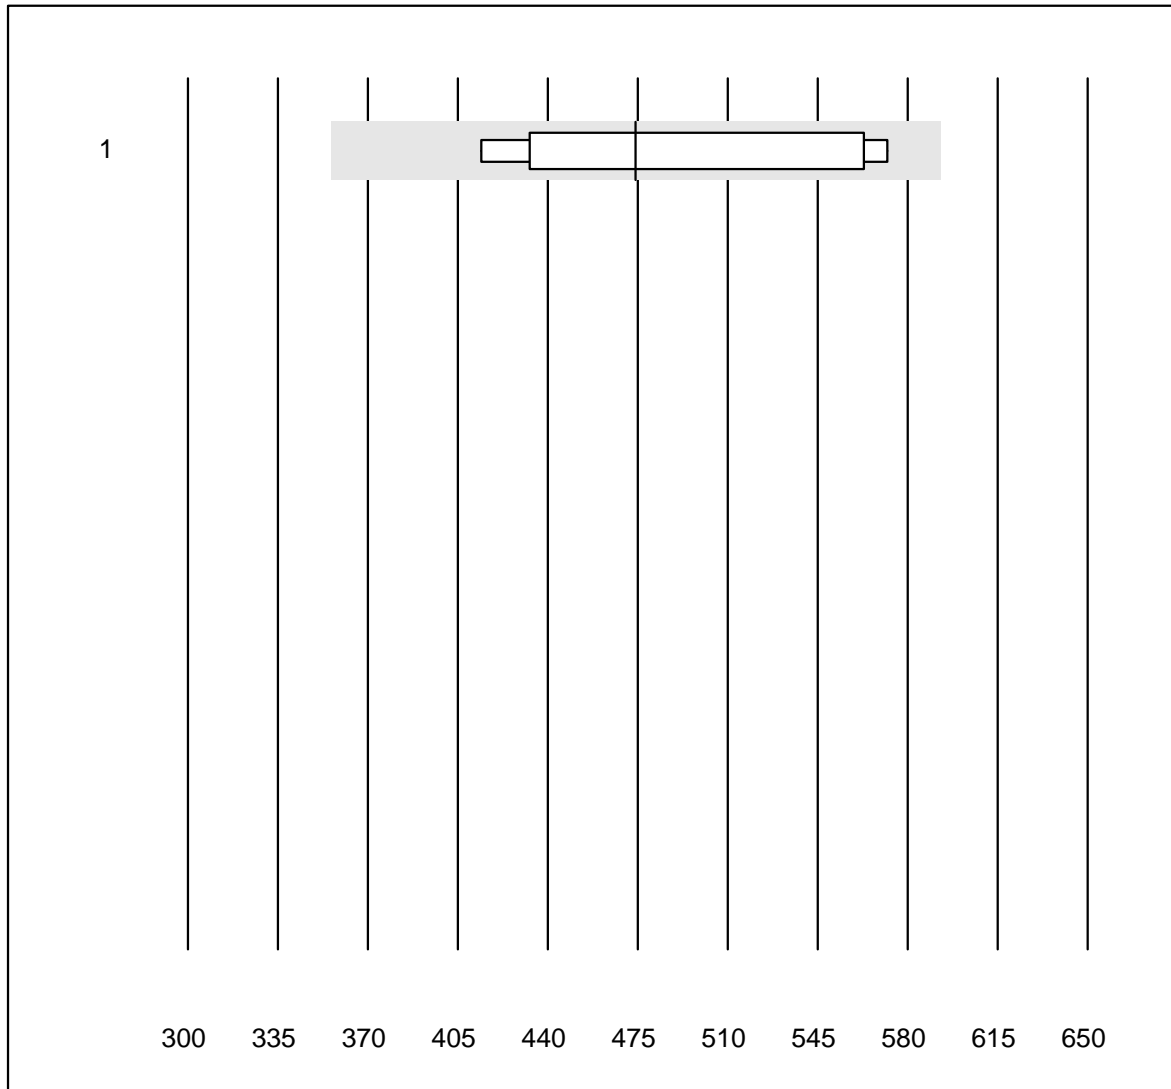

Tolérance QUALAB : 25 % Folates érythrocytaires échantillon A (nmol/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Architect	8	75.0	0.0	25.0	474	14.0	e*

BNP

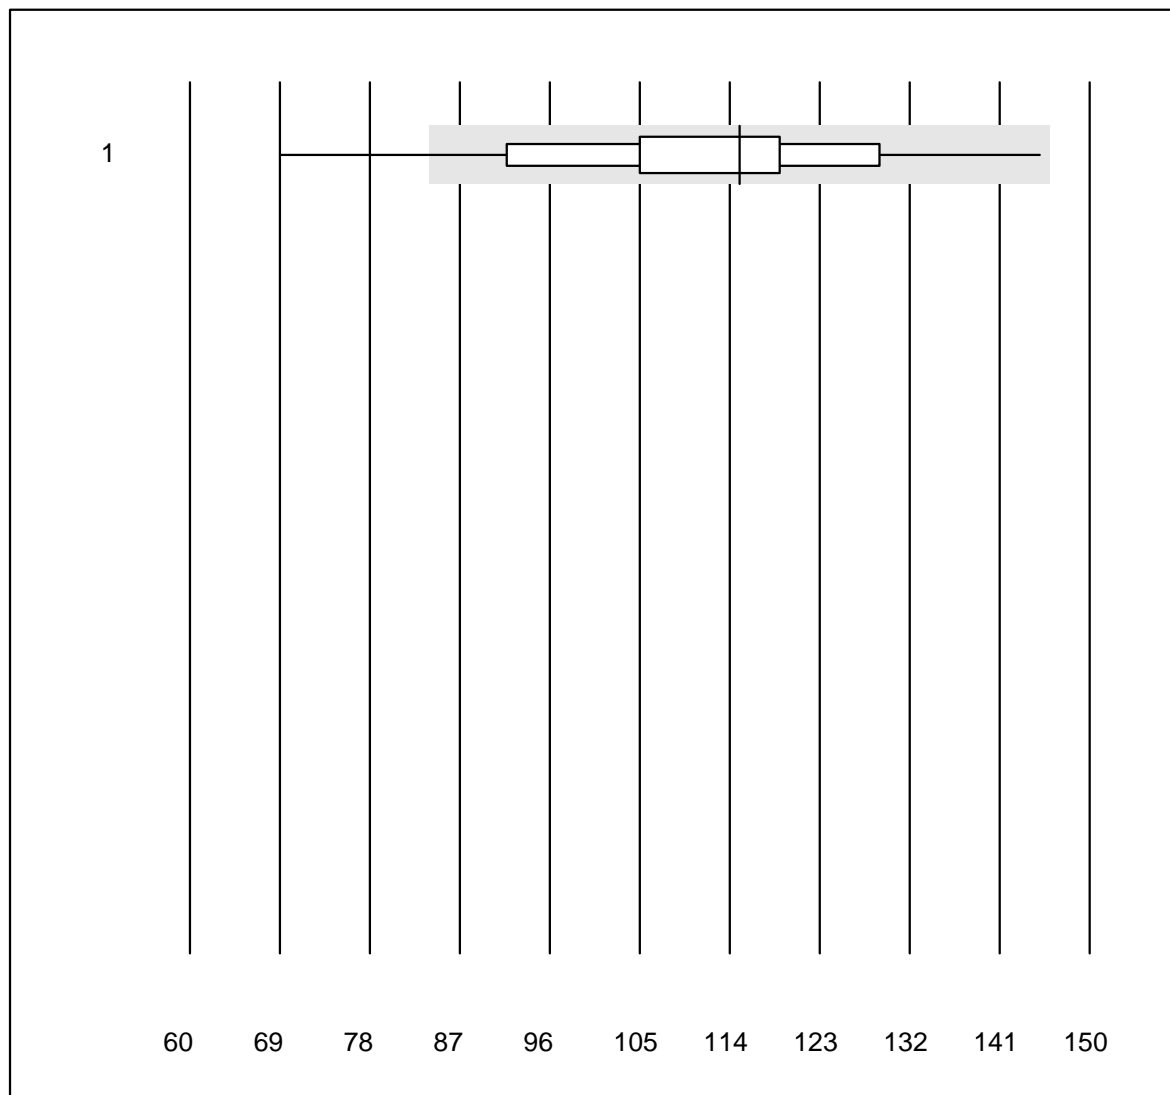


Tolérance QUALAB : 27 %

BNP (ng/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Triage	45	86.7	2.2	11.1	115.0	13.3	e

Troponin Triage

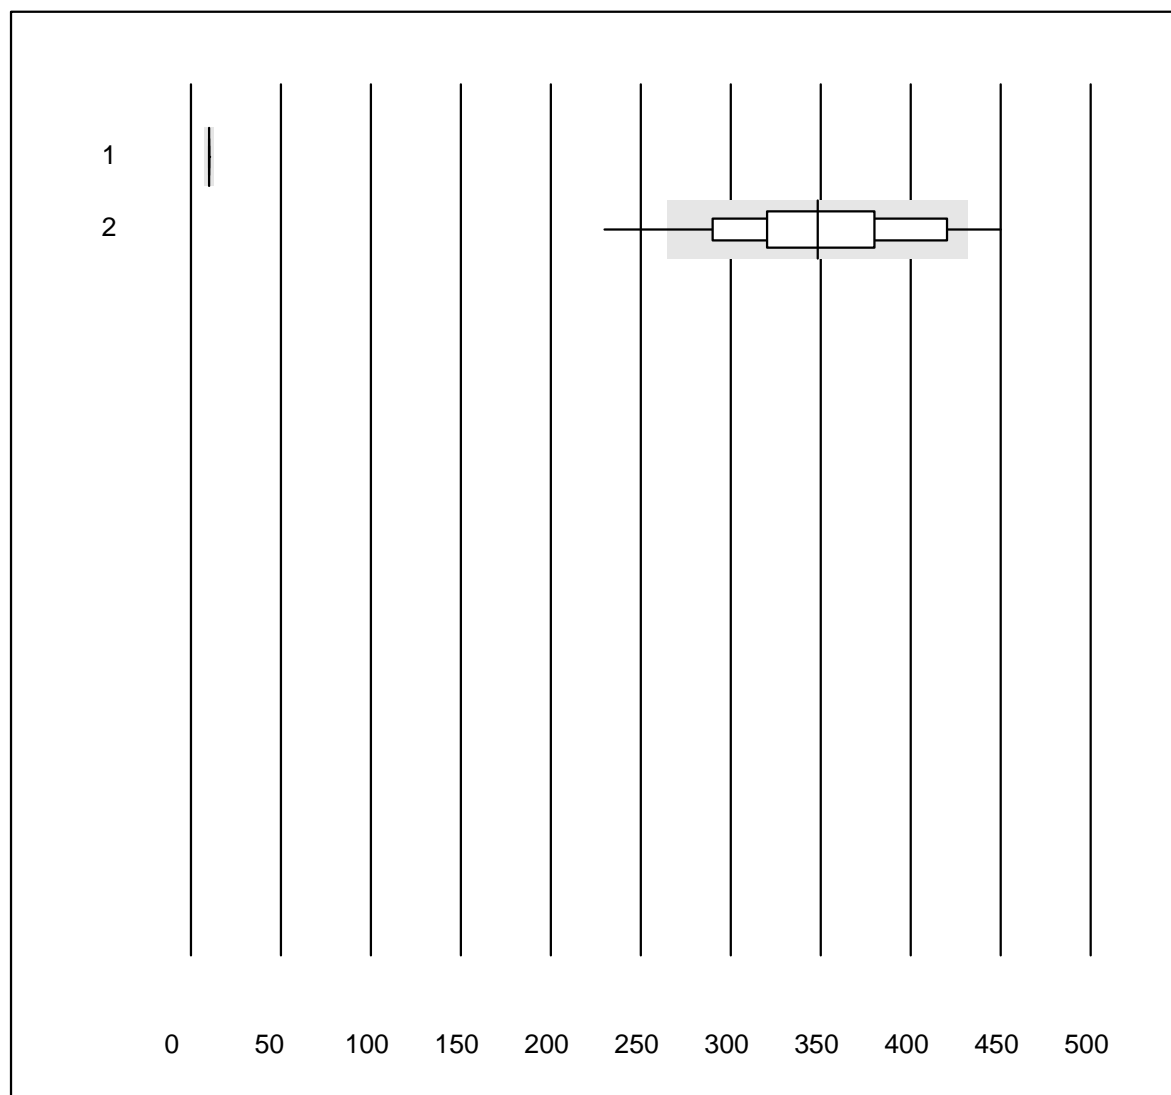


Tolérance QUALAB : 24 %

Troponin Triage (ng/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Triage Next Gen	38	86.8	0.0	13.2	10.00	0.0	a
2	Triage SOB/Cardiac	22	68.2	9.1	22.7	348.24	15.6	e*

NT-Pro-BNP

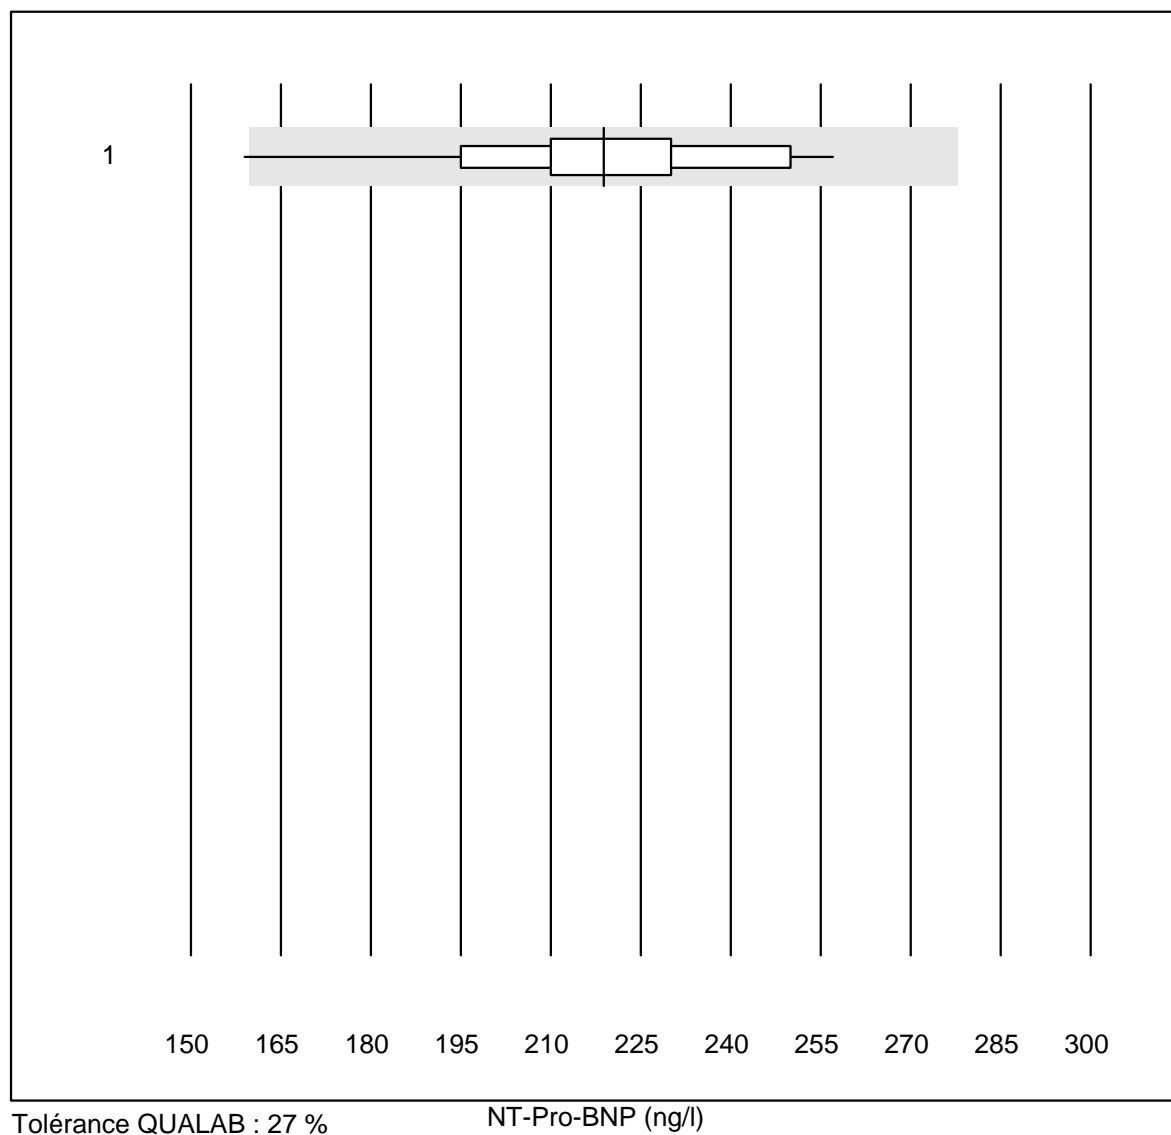

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Triage	13	92.3	7.7	0.0	219	11.6	e

D-Dimere Triage

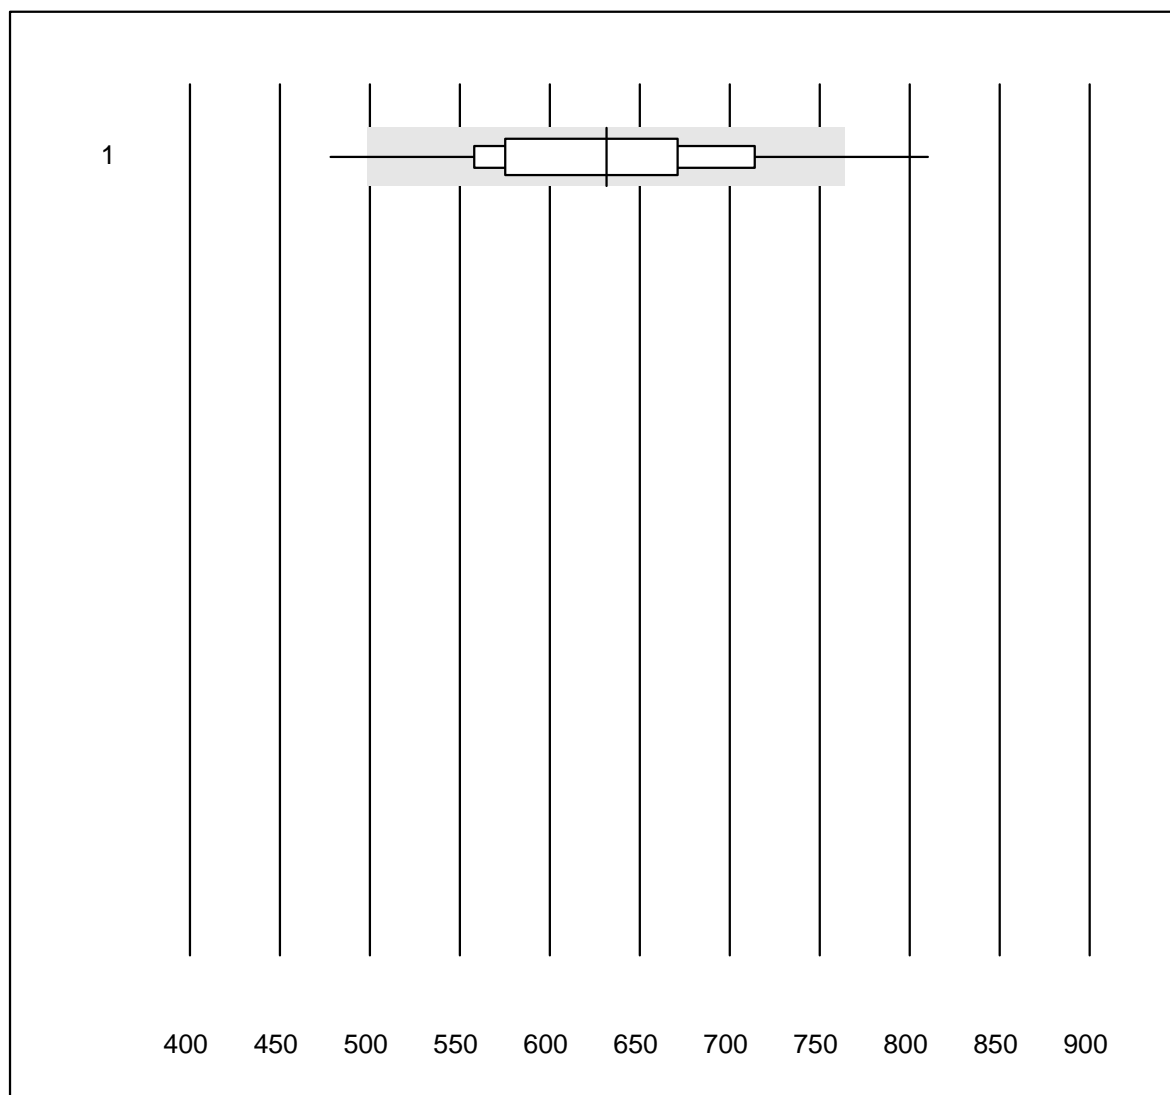


Tolérance QUALAB : 21 %

D-Dimere Triage (ng/ml)

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Triage	56	94.6	3.6	1.8	631.36	10.4	e

CK-MB Triage

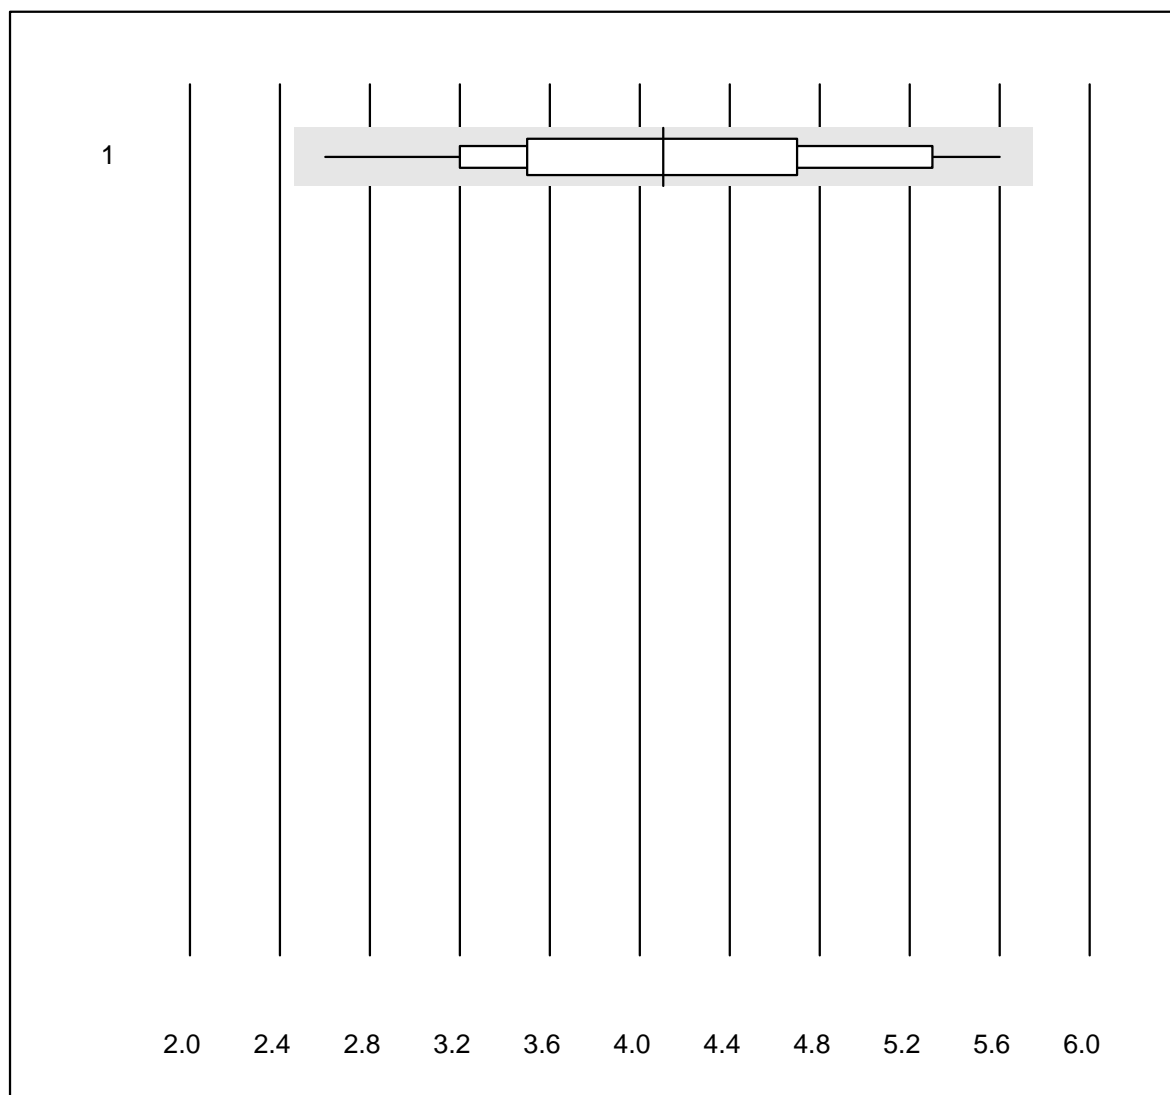


Tolérance QUALAB : 40 %

CK-MB Triage (µg/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Triage	20	95.0	0.0	5.0	4.1	19.0	e

Myoglobin Triage

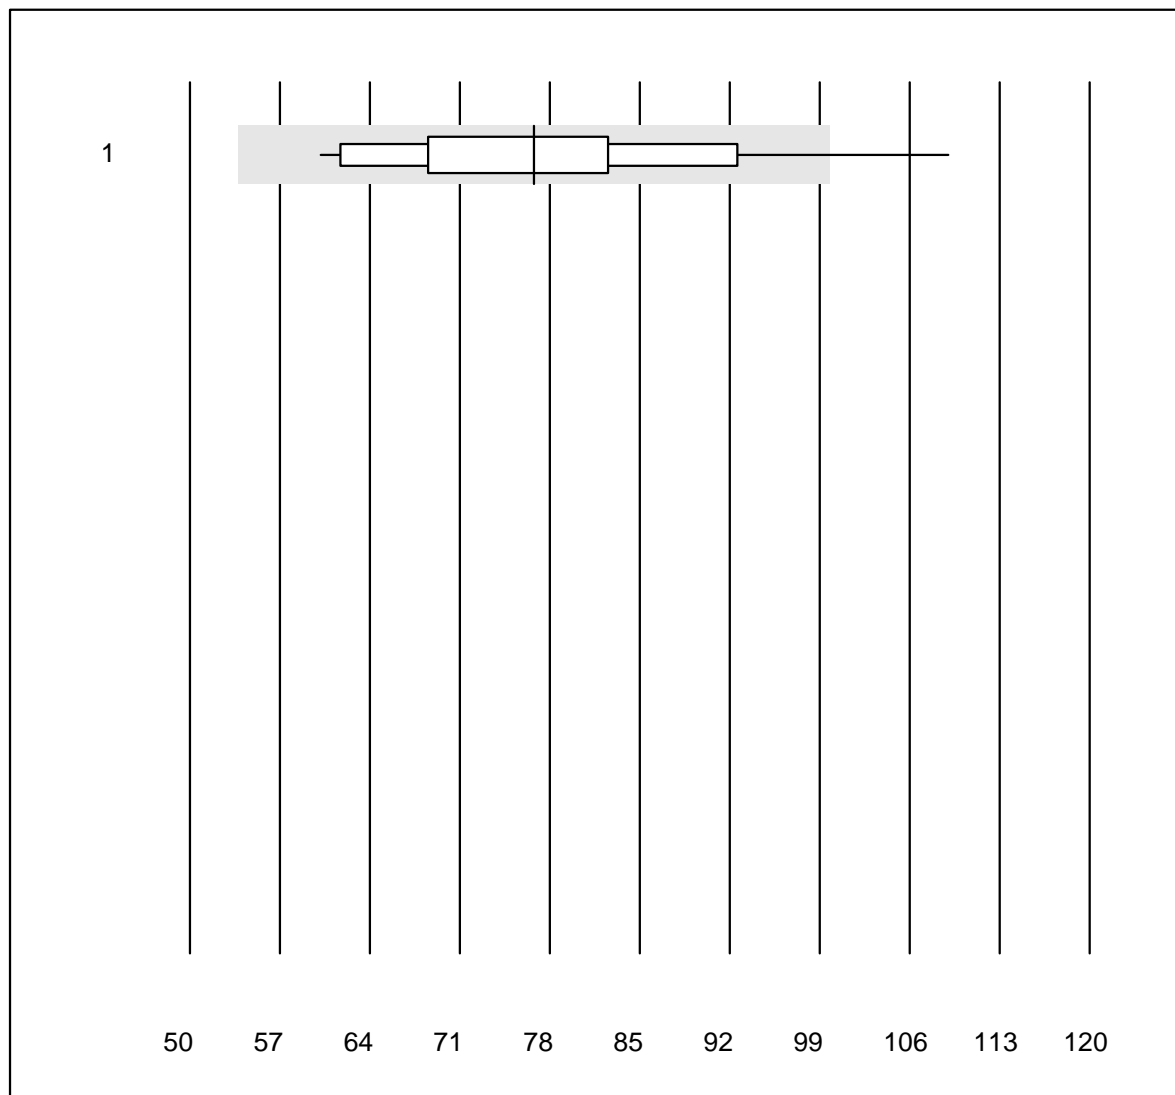


Tolérance QUALAB : 30 %

Myoglobin Triage (µg/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Triage	18	88.8	5.6	5.6	76.8	16.2	e*

Amylase - urine

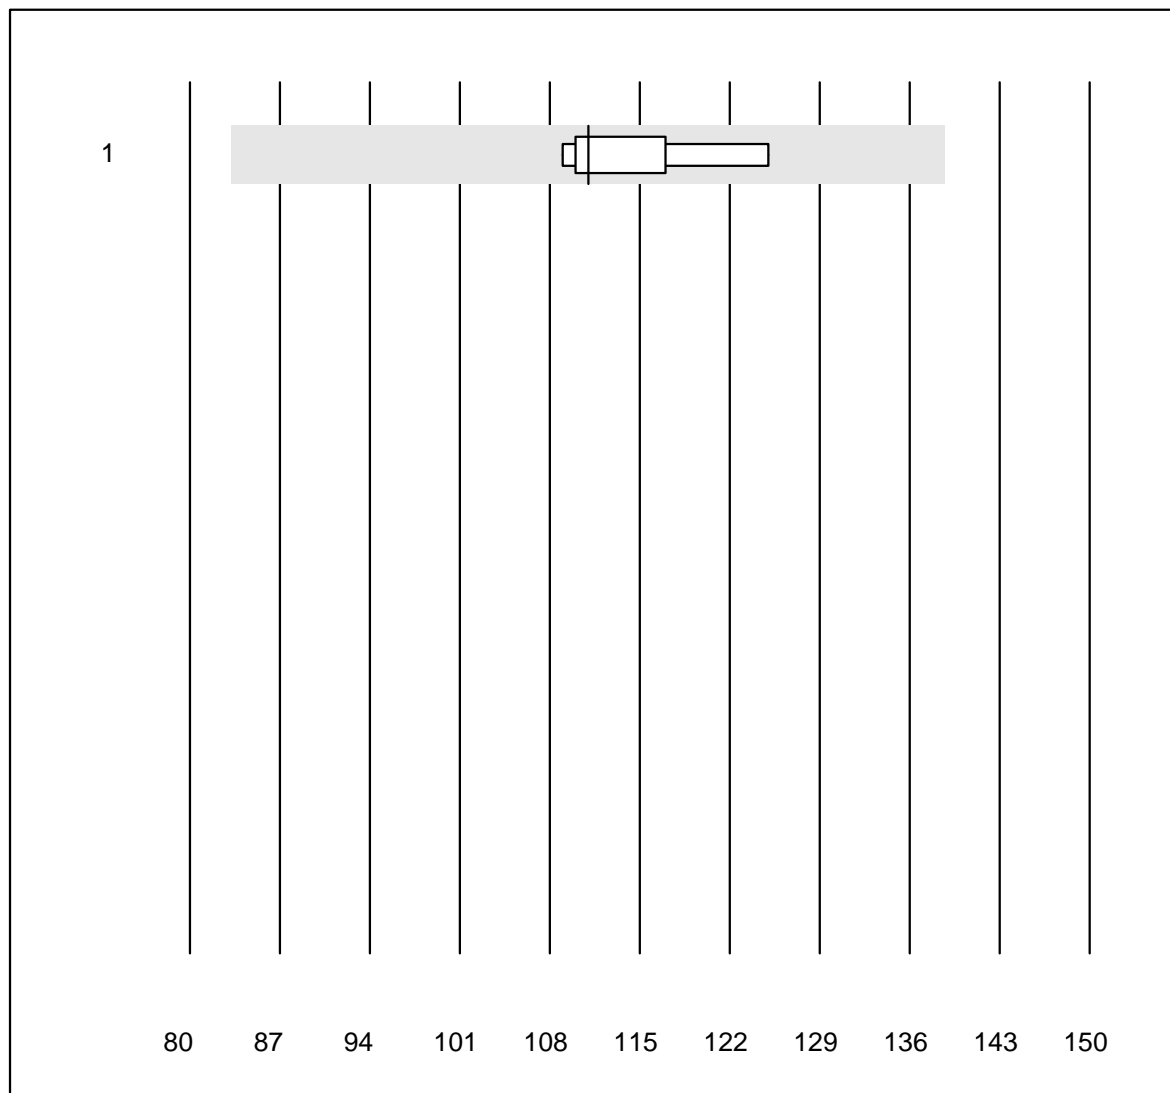


Tolérance QUALAB : 25 %

Amylase - urine (U/l)

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 IFCC	5	100.0	0.0	0.0	111	5.9	e

Calcium - urine

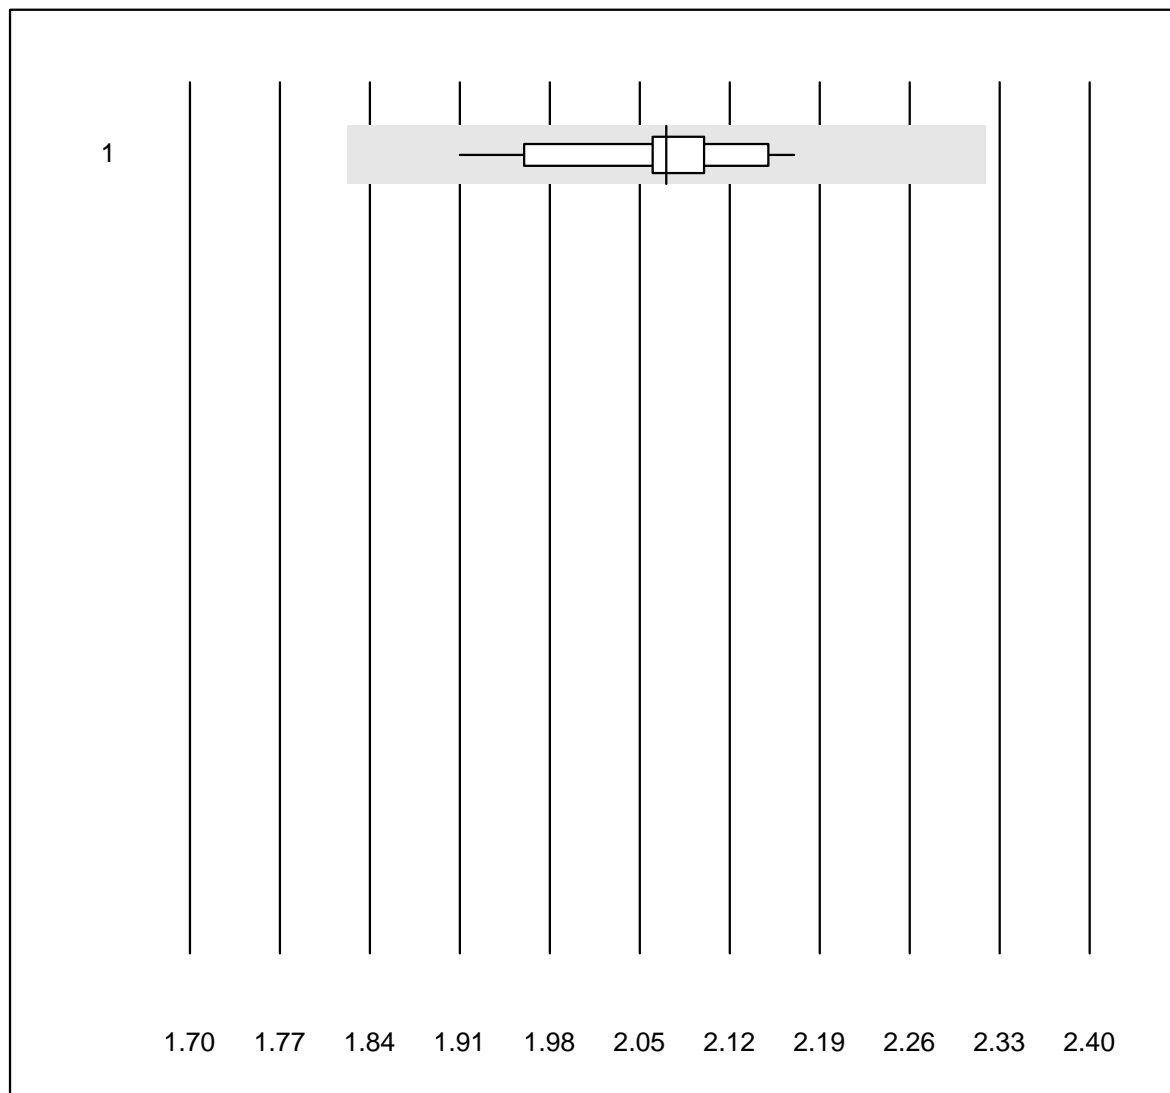


Tolérance QUALAB : 12 %

Calcium - urine (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	15	100.0	0.0	0.0	2.07	3.4	e

Chlorures - urine

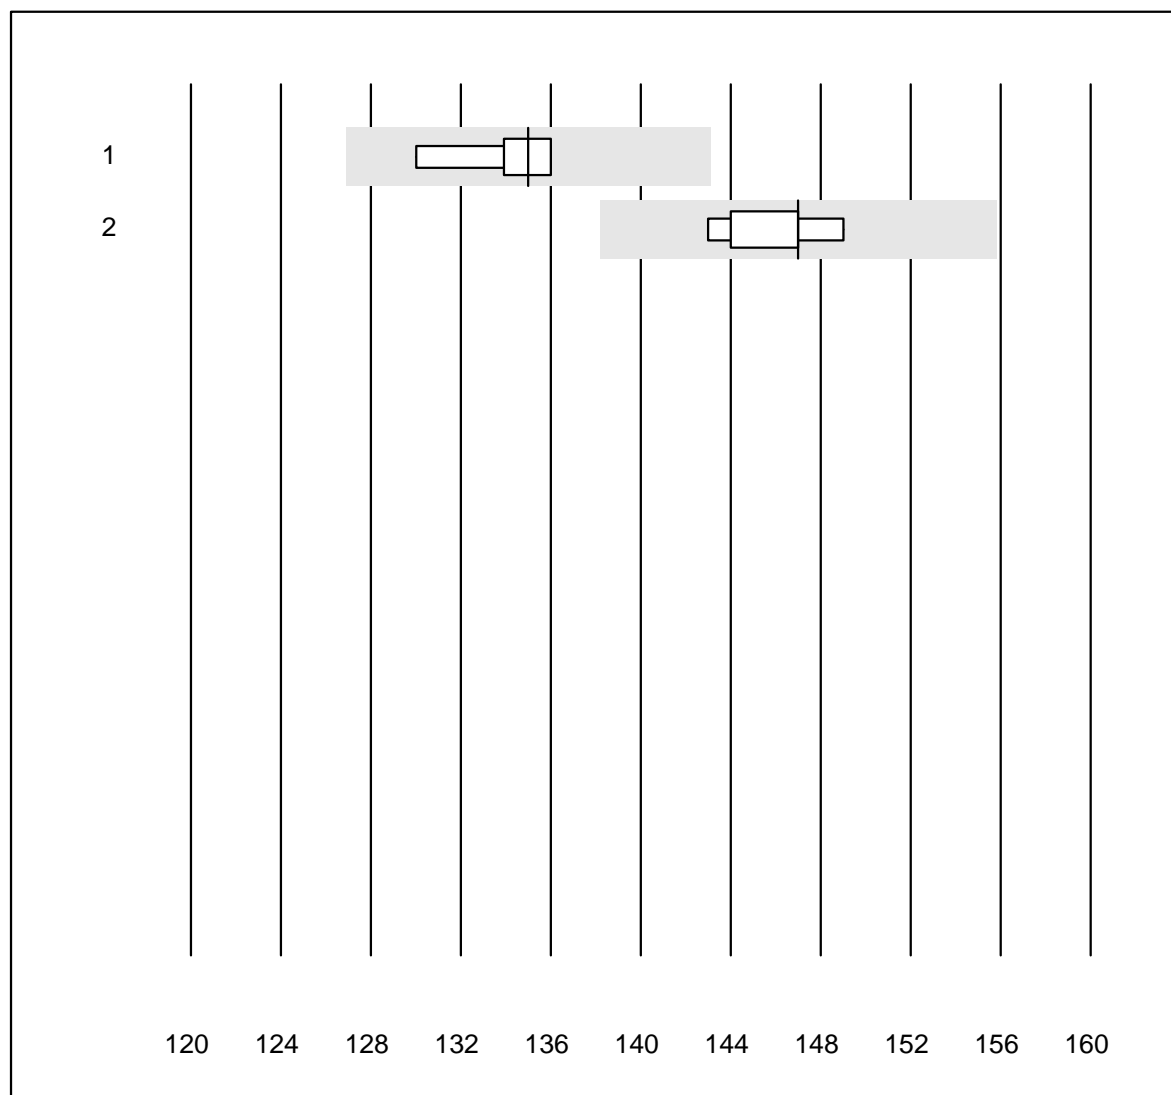


Tolérance QUALAB : 6 %

Chlorures - urine (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas	7	100.0	0.0	0.0	135	1.5	e
2	Chimie humide	6	100.0	0.0	0.0	147	1.5	e

Glucose - urine

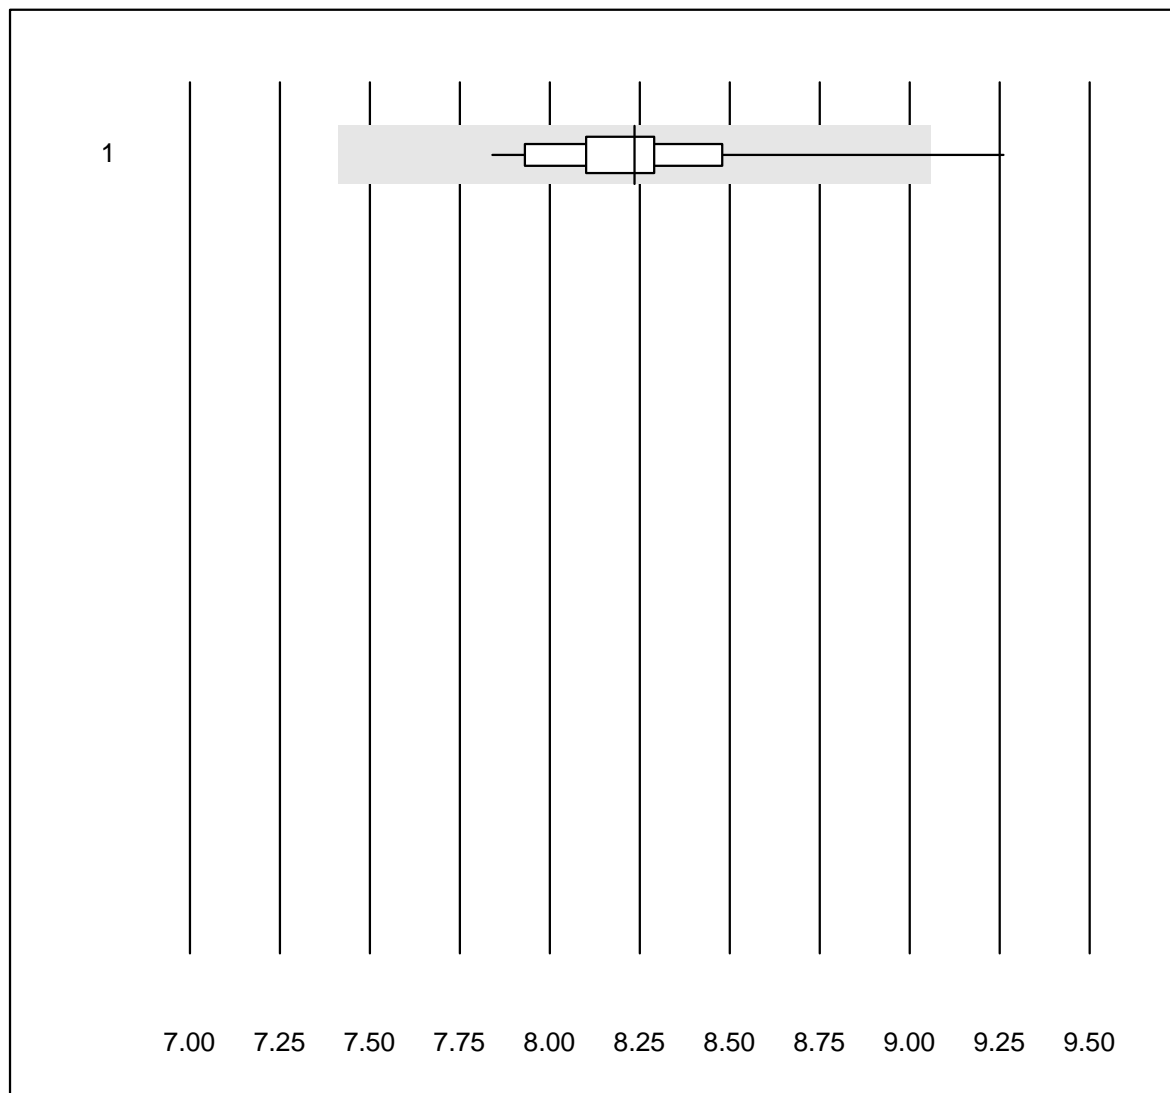


Tolérance QUALAB : 10 %

Glucose - urine (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	17	94.1	5.9	0.0	8.2	3.7	e

Magnésium - urine

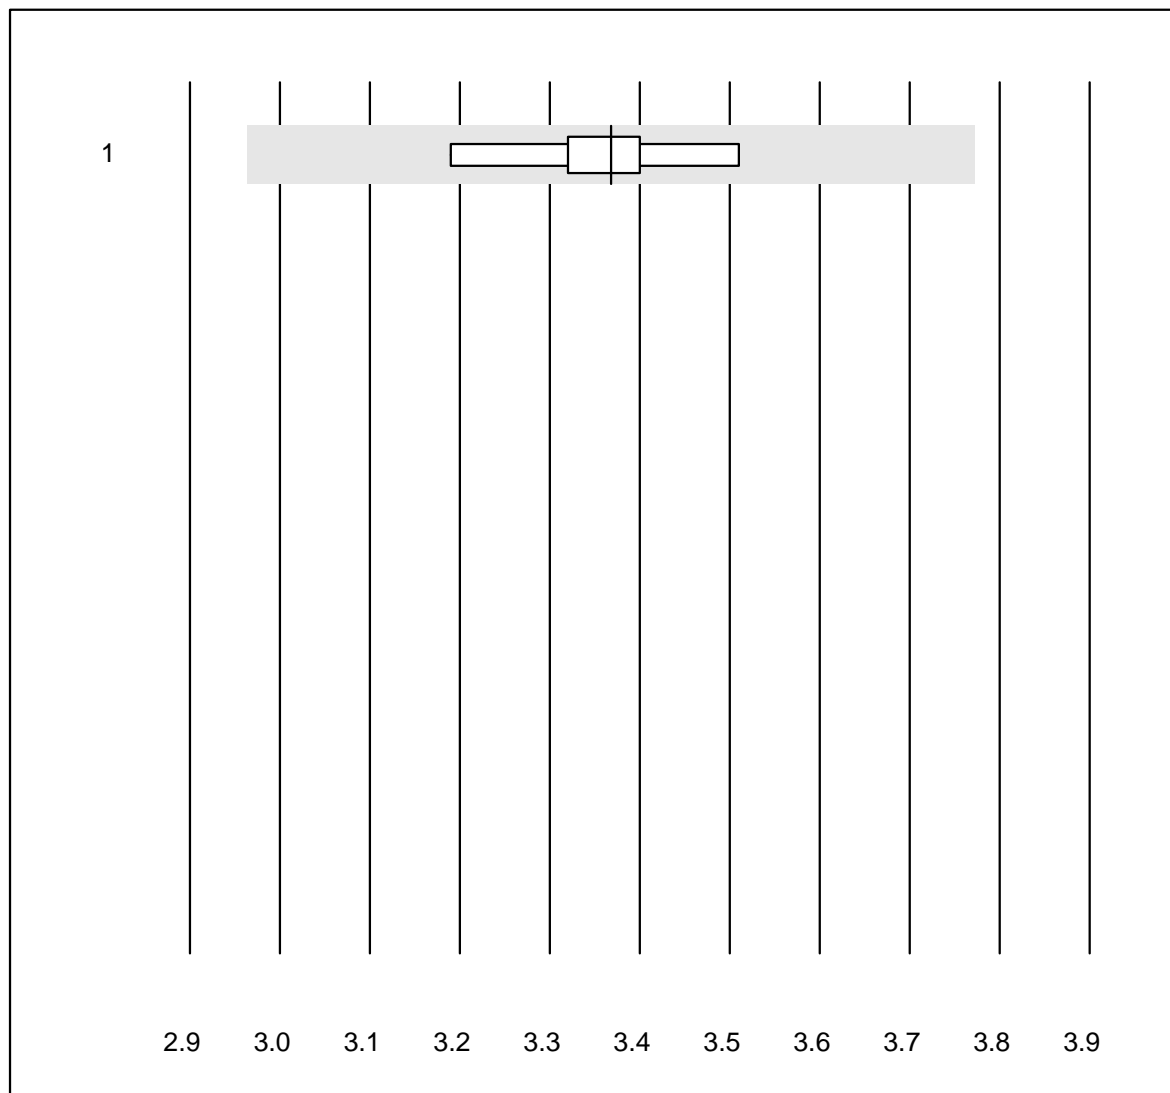


Tolérance QUALAB : 12 %

Magnésium - urine (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	10	100.0	0.0	0.0	3.37	2.9	e

Osmolalité -urine

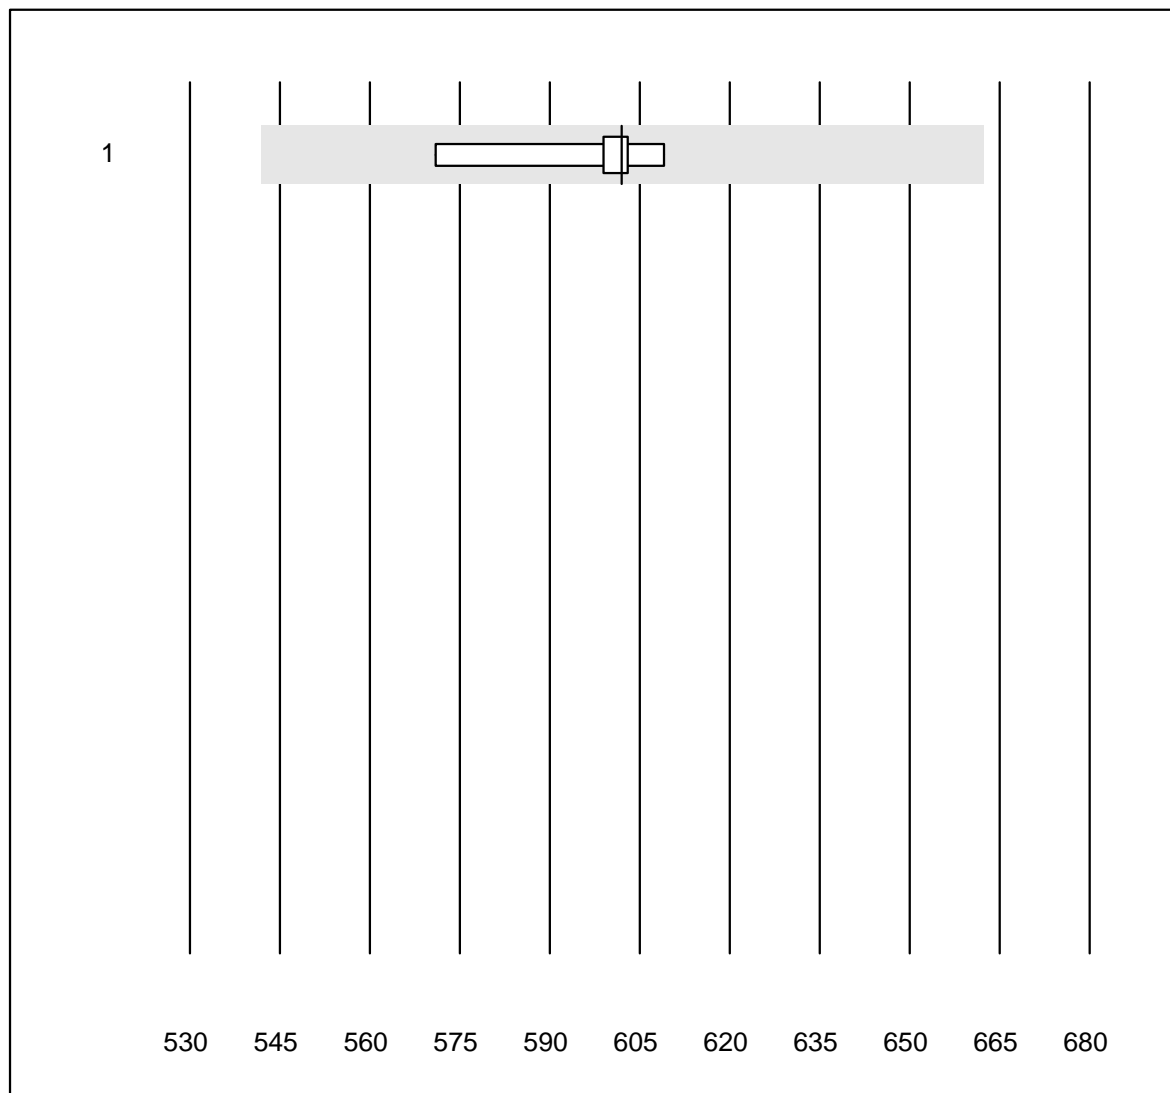


Tolérance QUALAB : 10 %

Osmolalité -urine (mosm/kg)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cryoscopie	9	100.0	0.0	0.0	602	1.8	e

Phosphore - urine

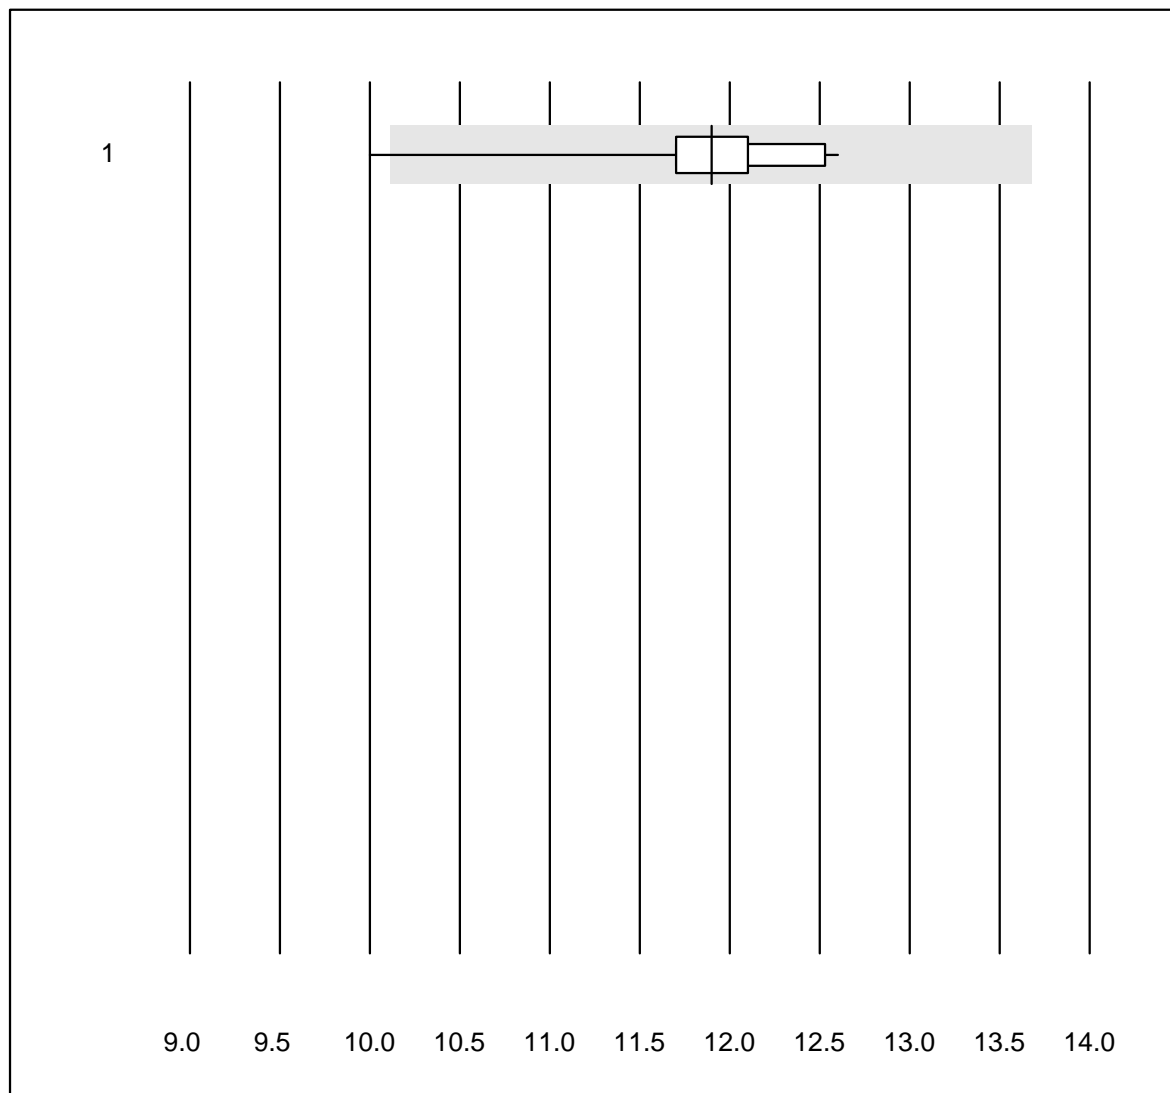


Tolérance QUALAB : 15 %

Phosphore - urine (mmol/l)

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Chimie humide	15	93.3	6.7	0.0	11.9	5.1	e

Potassium - urine

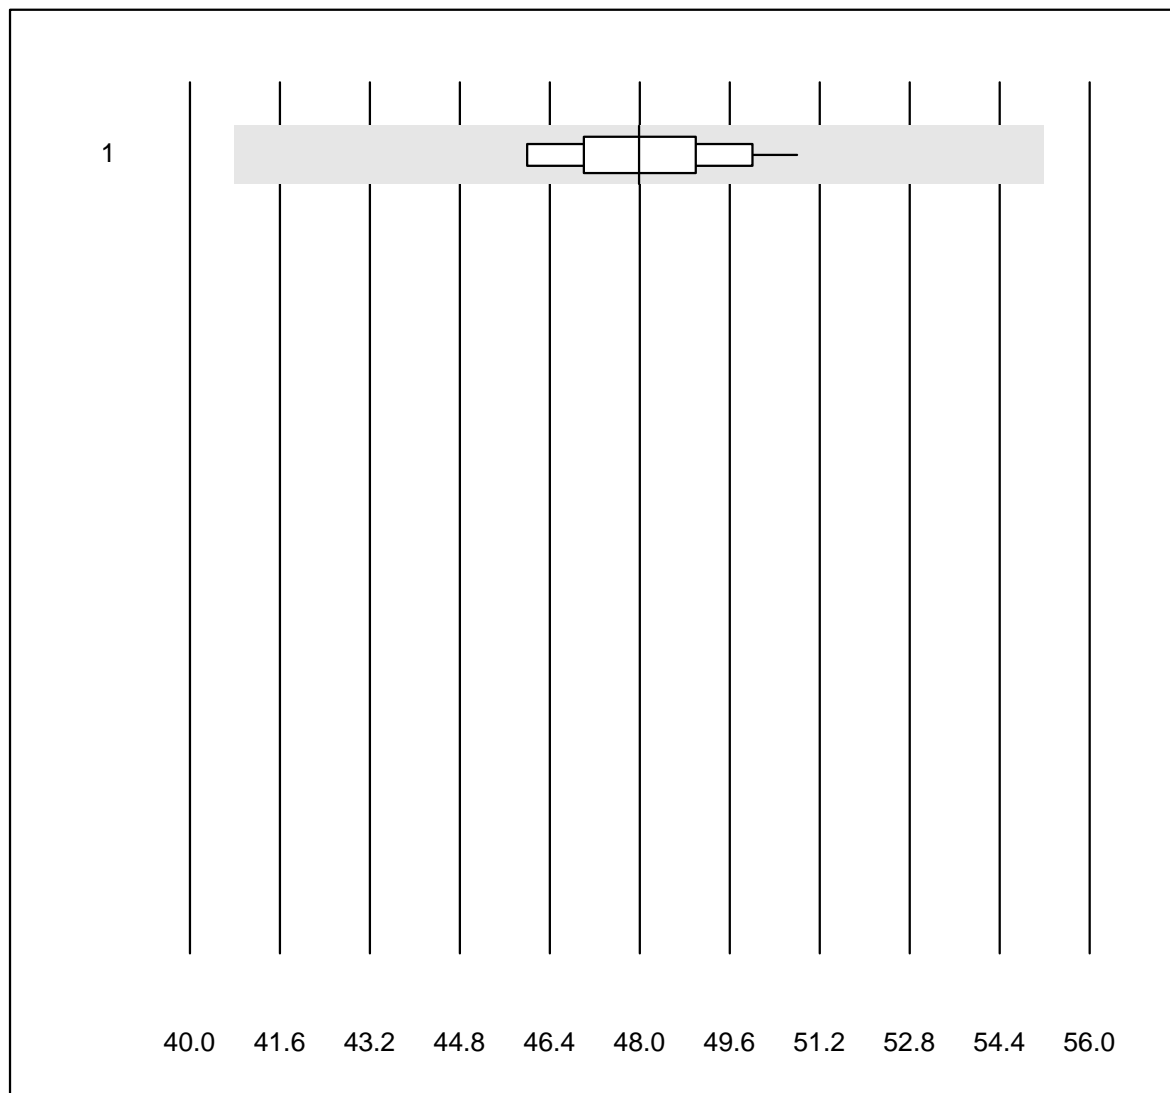


Tolérance QUALAB : 15 %

Potassium - urine (mmol/l)


No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 toutes les méthodes	24	100.0	0.0	0.0	48	2.9	e

Protéines - urine

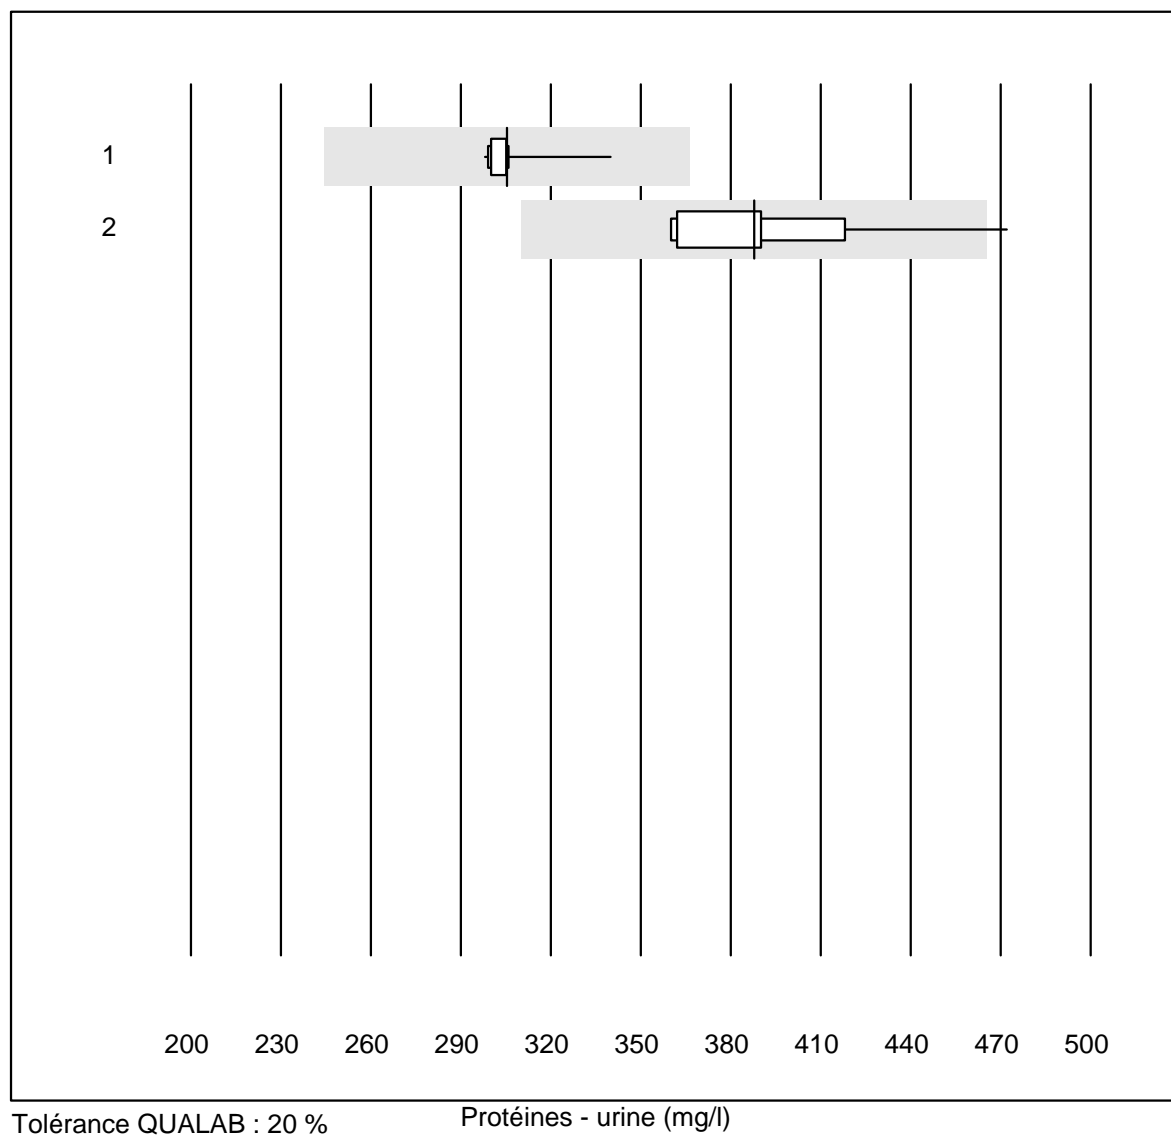

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas/Roche	12	100.0	0.0	0.0	305.3	3.7	e
2	Chimie humide	10	90.0	10.0	0.0	387.8	8.9	e*

Sodium - urine

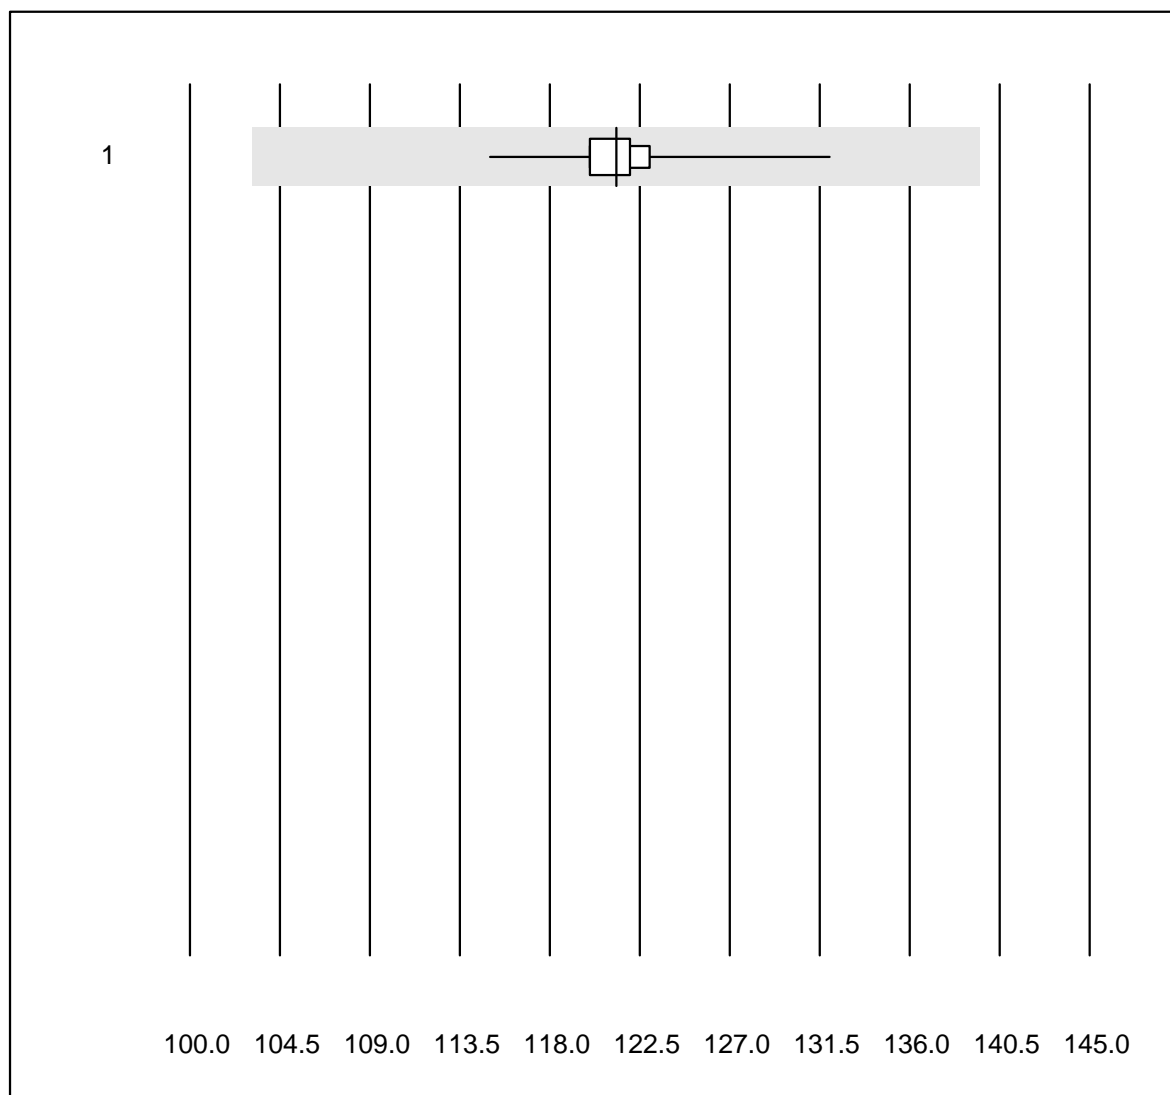


Tolérance QUALAB : 15 %

Sodium - urine (mmol/l)

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 toutes les méthodes	24	100.0	0.0	0.0	121	2.5	e

Urée - urine

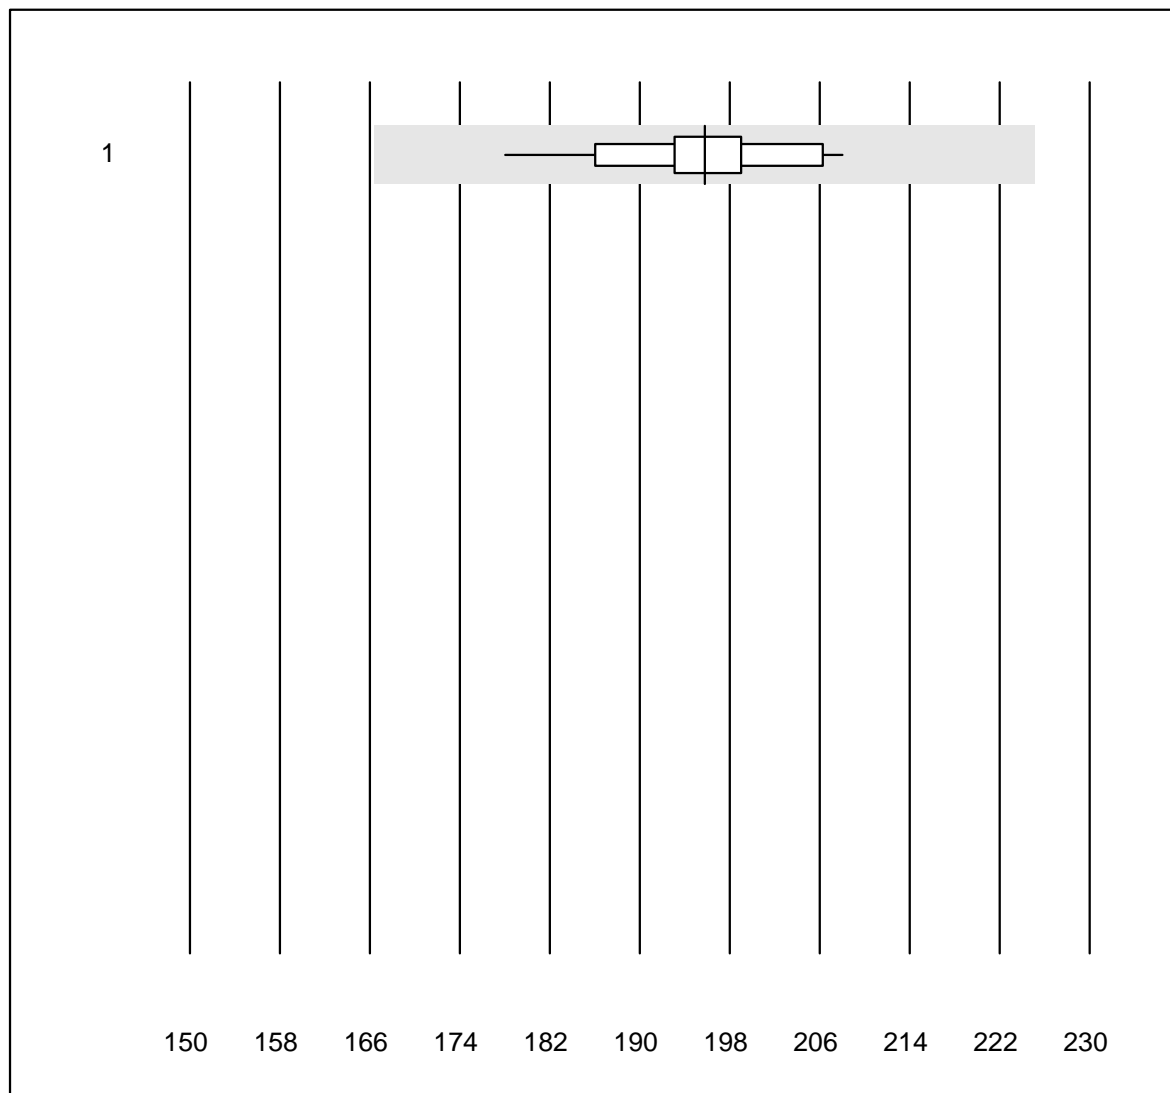


Tolérance QUALAB : 15 %

Urée - urine (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	19	100.0	0.0	0.0	196	3.6	e

Acide urique - urine

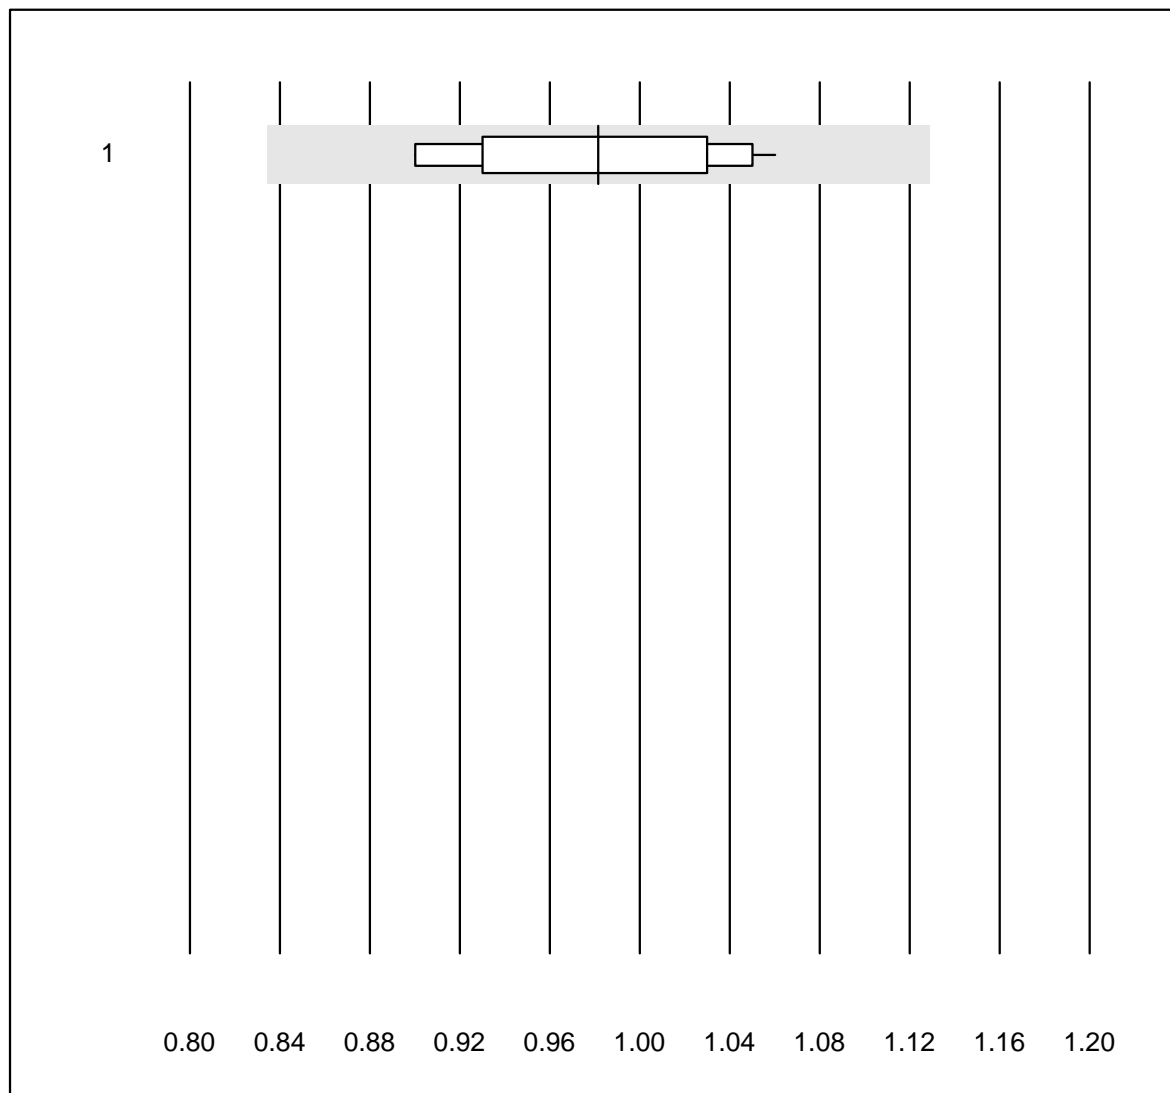


Tolérance QUALAB : 15 %

Acide urique - urine (mmol/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Chimie humide	16	100.0	0.0	0.0	0.98	5.6	e

Gravité spécifique - urine

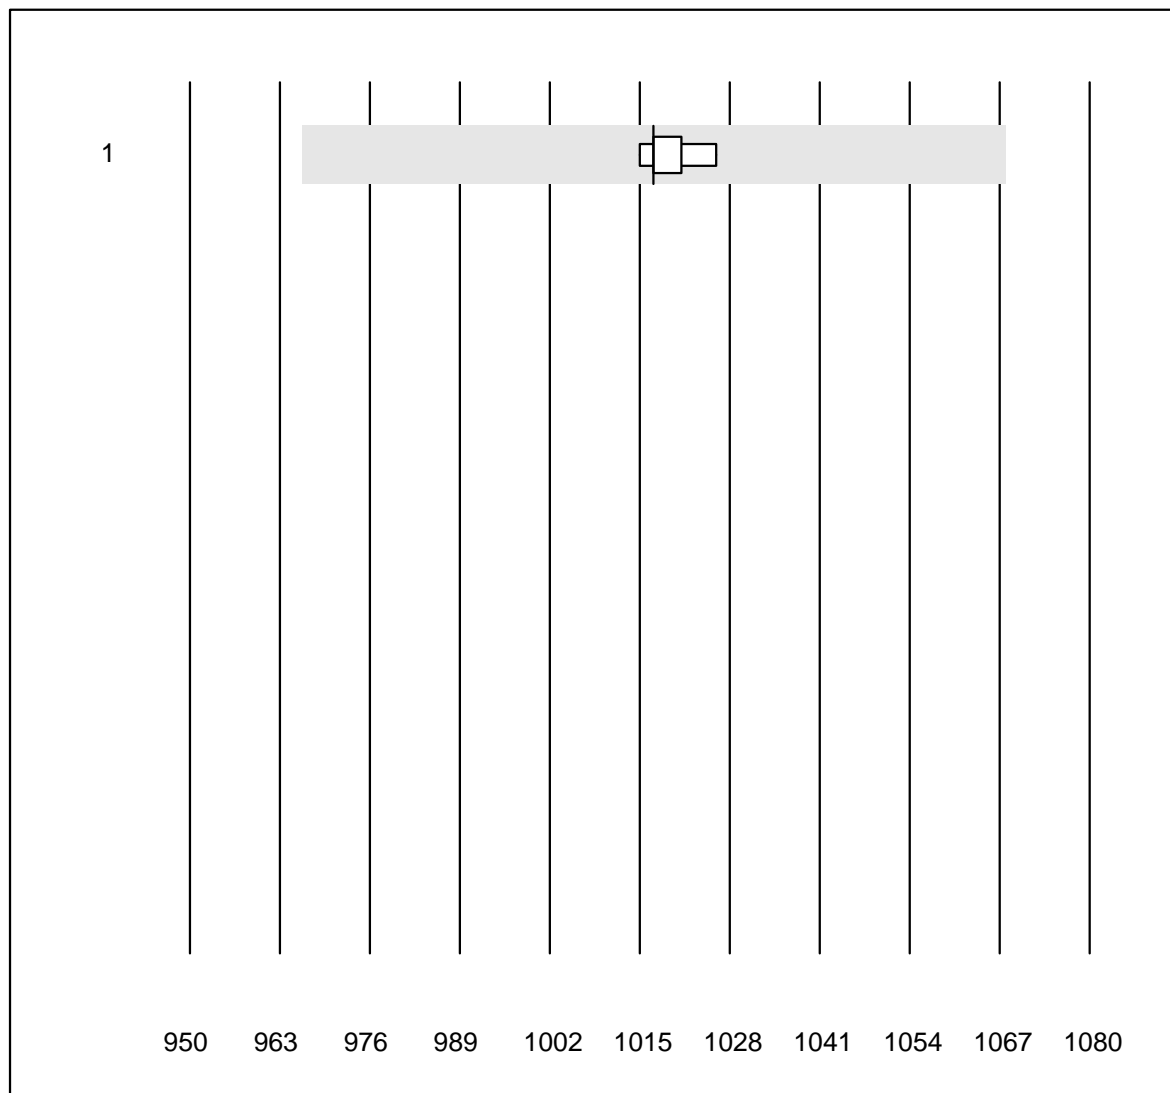


Tolérance QUALAB : 5 %

Gravité spécifique - urine ()


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Refraktometer	7	100.0	0.0	0.0	1017.000	0.4	e

Microalbumine

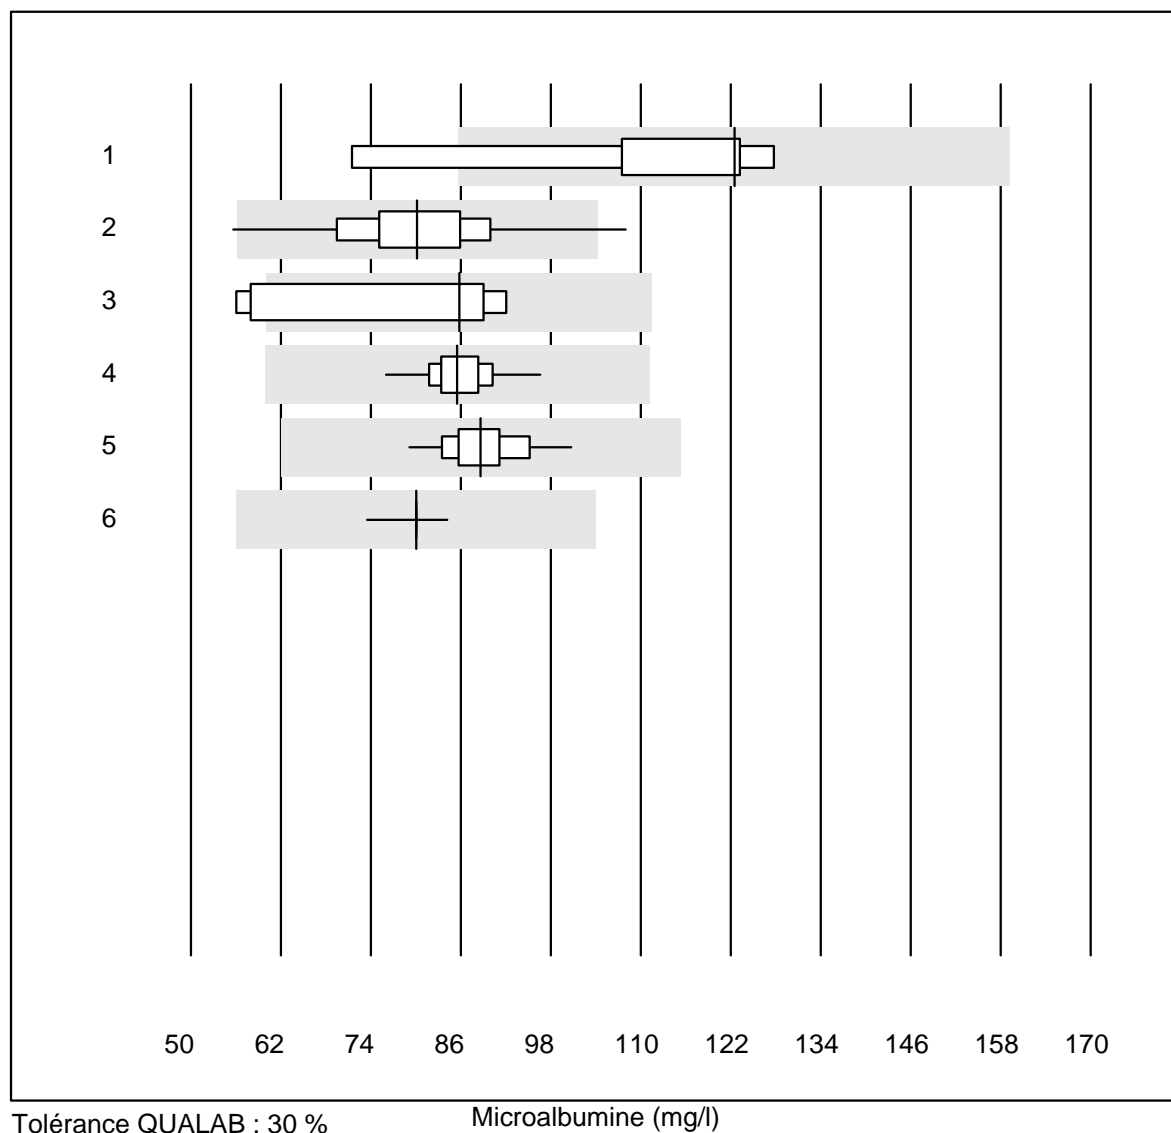

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	AFIAS	7	85.7	14.3	0.0	122.5	17.2	e*
2	Afinion	353	97.4	0.6	2.0	80.2	10.2	e
3	NycoCard	8	50.0	25.0	25.0	85.8	21.4	a
4	Turbidimétrie	21	100.0	0.0	0.0	85.5	5.1	e
5	DCA2000/Vantage	132	97.0	0.0	3.0	88.6	5.1	e
6	Siemens Clinitek	13	92.3	0.0	7.7	80.0	2.9	a

Créatinine U

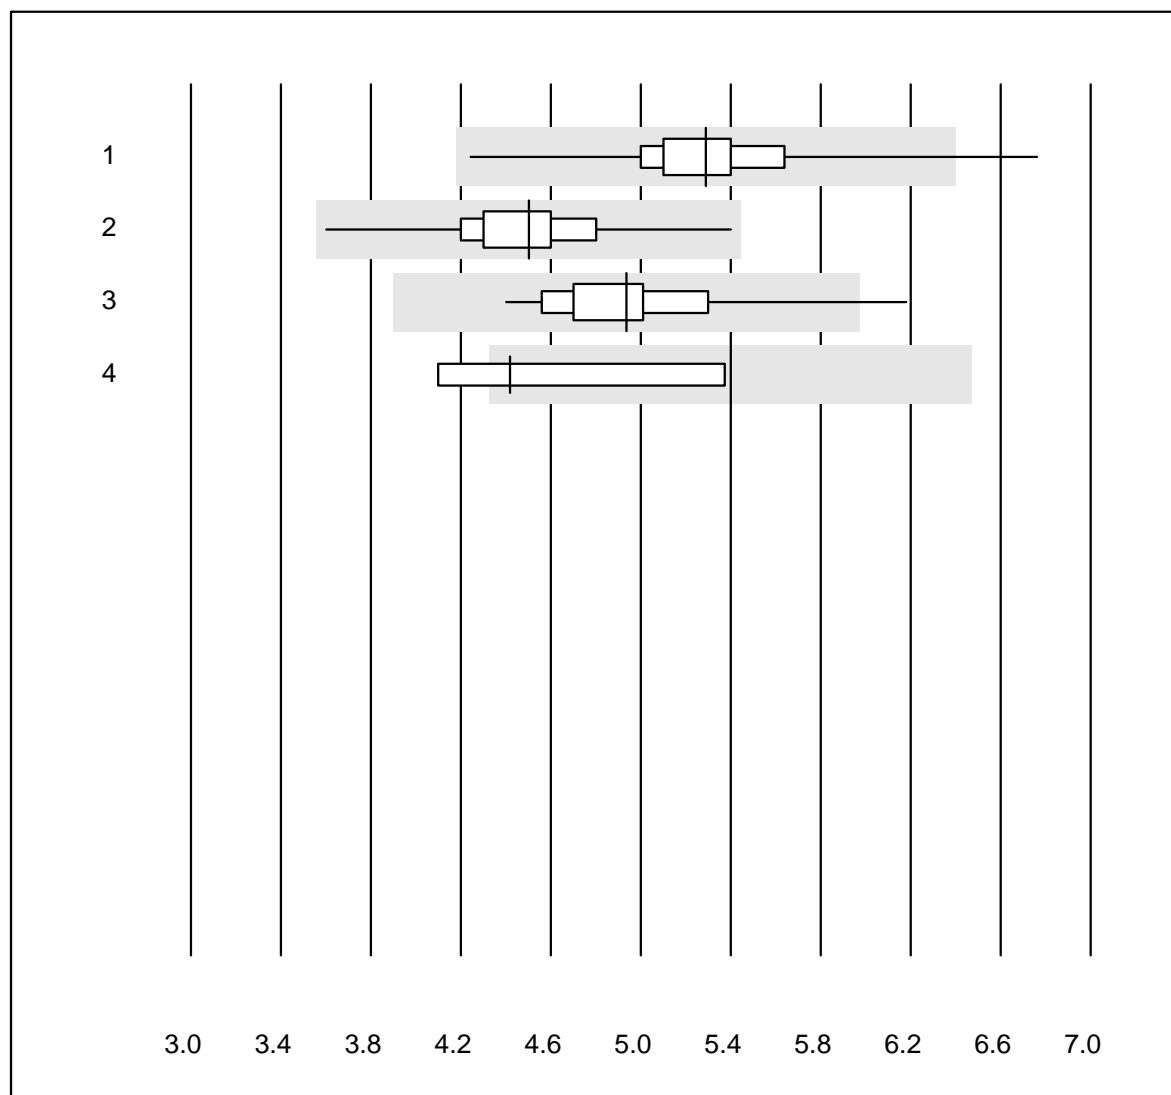

Tolérance QUALAB : 21 %

Créatinine U (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	DCA2000/Vantage	132	95.4	0.8	3.8	5.3	5.5	e
2	Afinion	352	98.9	0.0	1.1	4.5	5.3	e
3	Chimie humide	36	97.2	2.8	0.0	4.9	6.5	e
4	Siemens Clinitek	13	38.5	7.7	53.8	5.4	9.6	a