

Verein für
Association pour le
Associazione per il



medizinische Qualitätskontrolle
contrôle de qualité médical
controllo di qualità medico

Commentaire de l'essai interlaboratoire

2018 - 1

Échantillons de l'essai interlaboratoire

L'homogénéité et la stabilité ont été vérifiées pour tous les échantillons avant respectivement pendant l'envoi et aucune anomalie n'a été constatée. Les tests de conformité ont été réalisés par les laboratoires de l'Hôpital Universitaire de Zürich (<http://www.uzl.usz.ch/>).

Ont été produits spécifiquement pour MQ en sous-traitance les échantillons d'essai interlaboratoire suivants:

B1 Strep A Test, B2 Uricult, H4 Hématologie parasitaire, K14 Marqueur tumoral

Détermination des valeurs-cible

Pour chaque valeur-cible est indiqué le mode de détermination utilisé selon les termes de la norme ISO17043:2010, B2.1 (Colonne "Type"):

- a Valeur connue, sur la base de la production.
- b Valeur de référence certifiée lors de l'utilisation d'échantillons spécifiques
- c Valeur de référence déterminée par analyse
- d „Consensus value“ des laboratoires d'experts
- e „Consensus value“ des participants

Pour les groupes de méthode incluant plus de 9 participants, les valeurs cibles sont déterminées comme étant la „Consensus value“ ("e") des participants. Pour la détermination de ces valeurs cibles est utilisée la moyenne réalisée par le groupe de méthodes. Les résultats qui présentent un écart par rapport à la valeur cible supérieur à 1.5 fois la tolérance Qualab, sont considérés comme résultats aberrants et exclus du calcul de la valeur de référence. Les résultats des essais d'aptitude sont utilisés comme valeur de base pour éliminer les taux aberrants. Afin de mettre à disposition de tous les participants des valeurs-cible les plus pertinentes possibles, d'autres procédures peuvent également être utilisées pour des groupes de méthode plus restreints.

Incertitude dans la détermination des valeurs-cible

L'incertitude-type (u_x) est calculée à l'aide de la formule suivante (ISO13528):

$$u_x = (\text{Valeur-cible}/100) * (1.25/\text{Racine carrée du "nombre des participants"}) * \text{CV en \%}$$

- u_x est exprimée dans la même unité que la valeur-cible
- u_x peut être comparée avec l'écart-type du collectif des participants ($\text{Ecart-type} = \text{Valeur-cible} * \text{CV en \%} / 100$)
- Pour un nombre de participants >18, l'incertitude-type (u_x) est significativement plus petite que la dispersion du collectif des participants et peut donc être négligée.


Tolérances QUALAB et MQ

Pour les analyses obligatoires sont utilisées les tolérances fixées par Qualab (www.qualab.ch, contrôle de qualité externe). Pour les analyses non-obligatoires, les tolérances sont fixées par le directeur de MQ pilotant l'essai interlaboratoire.

Si l'incertitude déterminée de la valeur de référence u_x est supérieure à 15% de la tolérance QUALAB ou de MQ, la lettre qui caractérise le type de détermination de la valeur-cible est en outre marquée d'une étoile (par exemple "e*"). Nous rendons ainsi les participants attentifs au fait que l'incertitude de la valeur de référence peut avoir une influence sur l'évaluation.

Représentation graphique

La représentation graphique des résultats est la suivante:

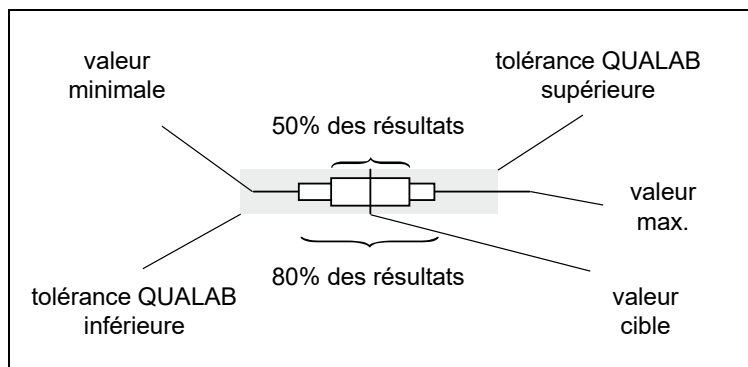


Comparaison des appareils

Les données de ce rapport vous permettent de comparer les performances respectives des divers appareils. Toutefois, vous devez tenir compte des points suivants:

- Le contrôle Chimie K1 est un sérum de contrôle commercialisé prêt à l'emploi. Même si l'échantillon est d'origine humaine, des effets matriciels sont possibles. Ceux-ci dépendent de l'appareil et peuvent générer des valeurs cible différentes.
- Seul un échantillon a été mesuré. La dispersion des résultats étant dépendante de la nature de l'échantillon (effets matriciels) et du niveau du résultat, les coefficients de variation déterminés (CV en %) ne sont pas toujours valables.
- Une grande partie des taux aberrants est due à des erreurs administratives (erreur d'unité, confusion des résultats) ou à des erreurs de manipulation (erreur d'échantillon, dissolution incorrecte, mélange insuffisant) et n'a rien à voir avec le type d'appareil.


Zürich, 4.4.2018



Dr. R. Fried
Directeur de l'essai interlaboratoire

Il n'est pas autorisé de publier une partie ou l'intégralité de ce rapport sans notre accord écrit préalable. L'original est conservé dans les archives sous www.mqzh.ch.

Quick OA

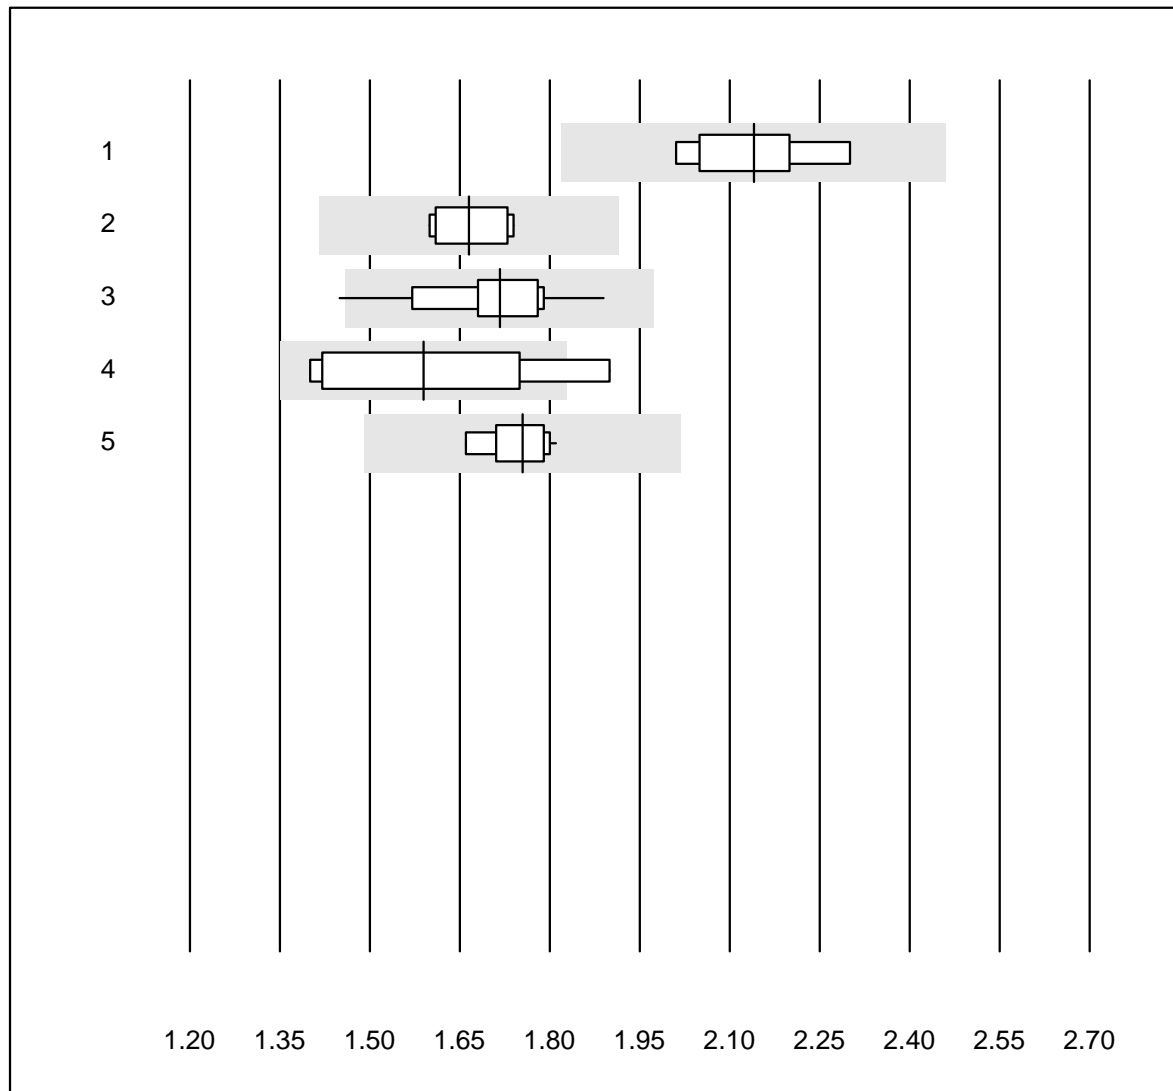


Tolérance QUALAB : 15 %

Quick OA ()

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Neoplastin Plus	7	100.0	0.0	0.0	2.14	4.7	e
2 Innovin	11	100.0	0.0	0.0	1.67	3.3	e
3 Recombiplastin 2G	17	94.1	5.9	0.0	1.72	5.7	e
4 Eurolyser	7	71.4	14.3	14.3	1.59	12.4	e*
5 Neoplastin R	10	100.0	0.0	0.0	1.76	3.0	e

Fibrinogène OA

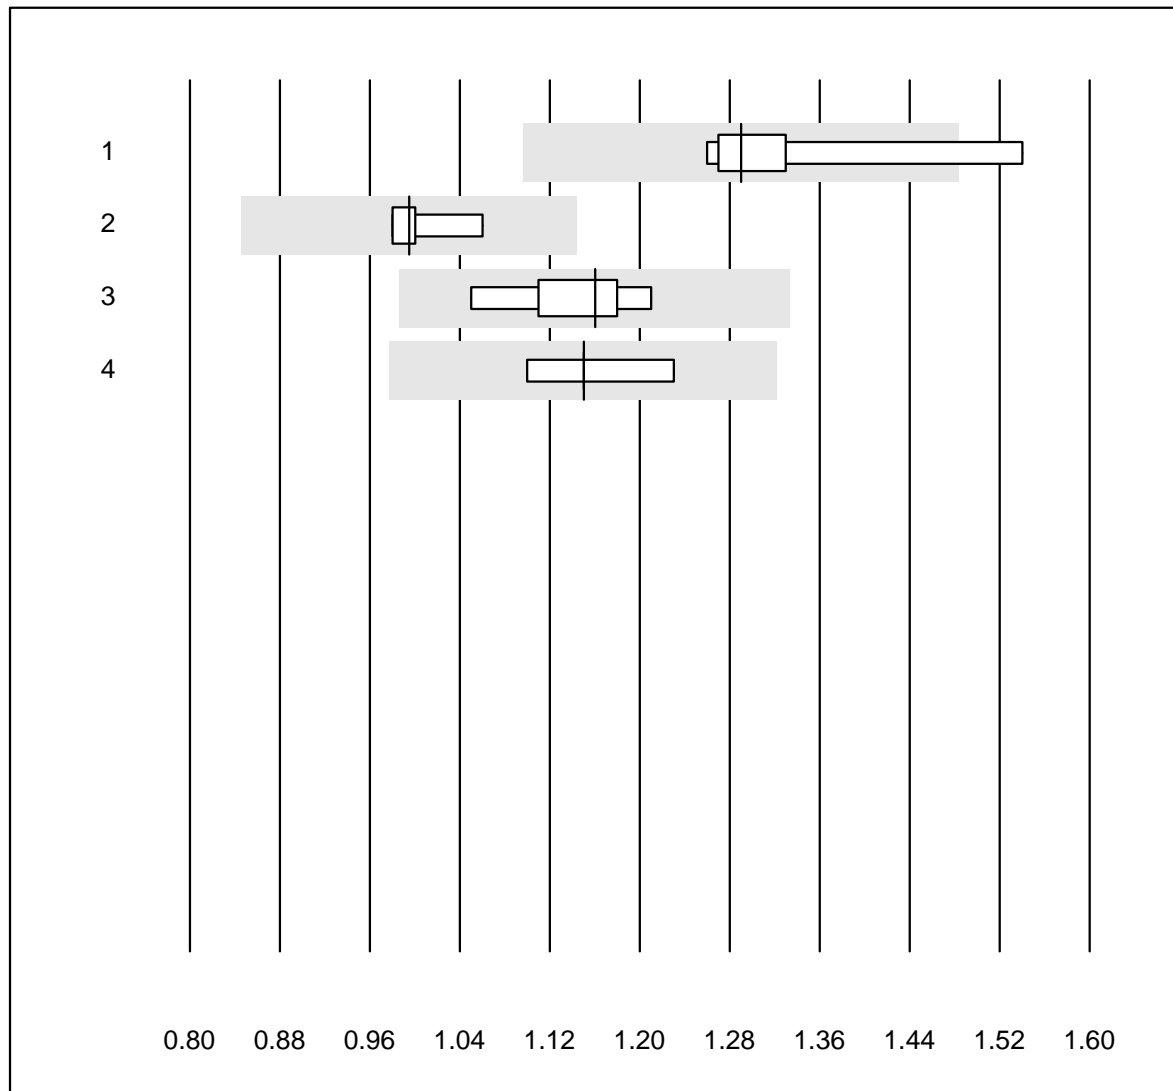


Tolérance QUALAB : 15 %

Fibrinogène OA (g/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Autres méthodes	6	83.3	16.7	0.0	1.29	8.0	e*
2	Siemens Thrombin	4	100.0	0.0	0.0	1.00	3.6	e
3	Stago/STA	9	100.0	0.0	0.0	1.16	5.1	e
4	Fibrinogen Q.F.A.	5	100.0	0.0	0.0	1.15	4.0	e*

aPTT OA

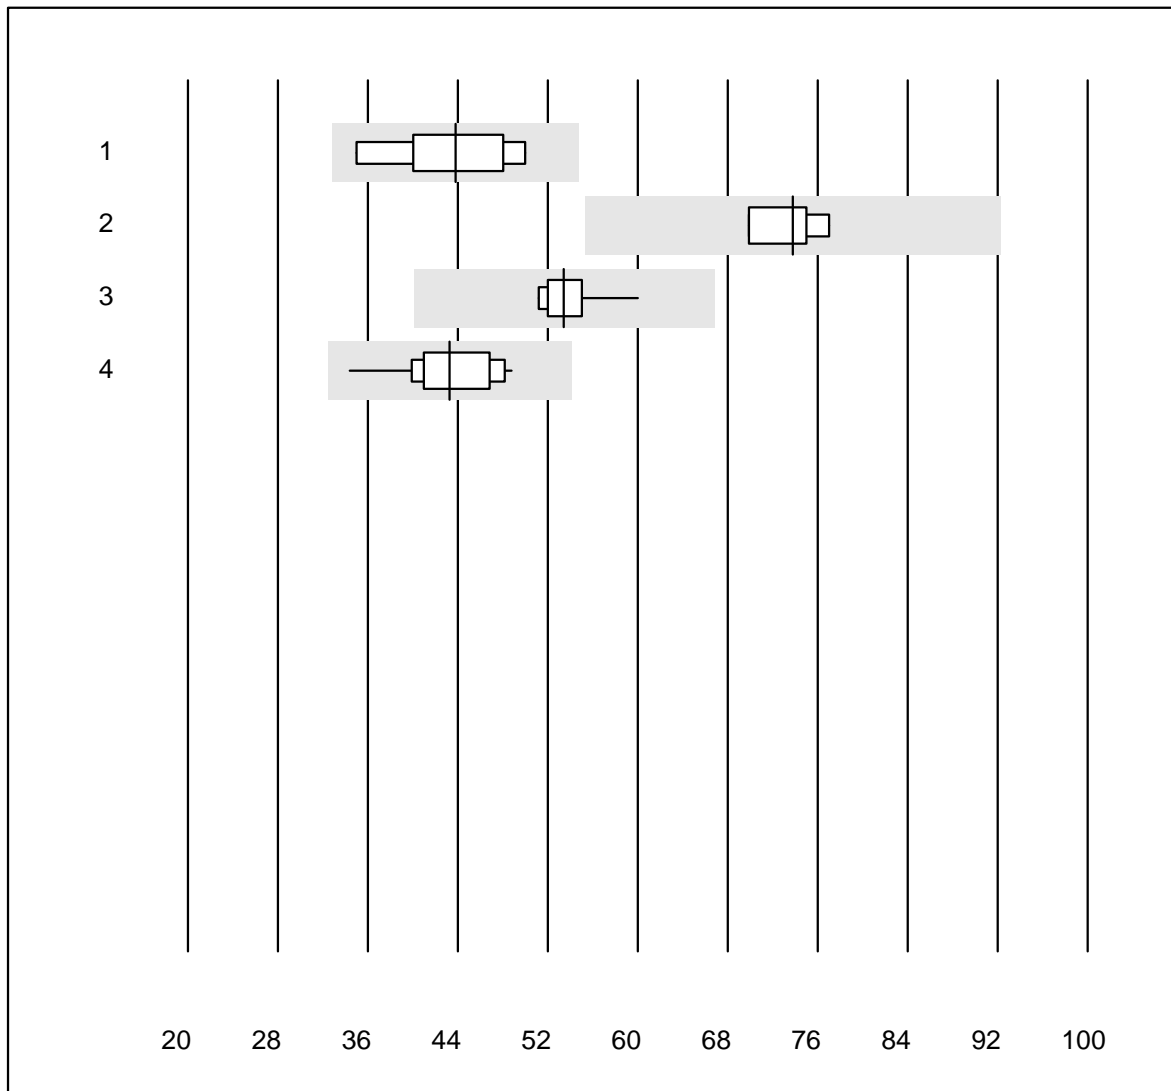


Tolérance QUALAB : 25 %

aPTT OA (Sek)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Actin FS	7	100.0	0.0	0.0	43.8	11.4	e*
2	Pathromtin SL	4	100.0	0.0	0.0	73.8	4.2	e
3	Stago/STA	11	90.9	0.0	9.1	53.4	5.0	e
4	aPTT-SP	11	100.0	0.0	0.0	43.3	9.7	e

INR CoaguChek

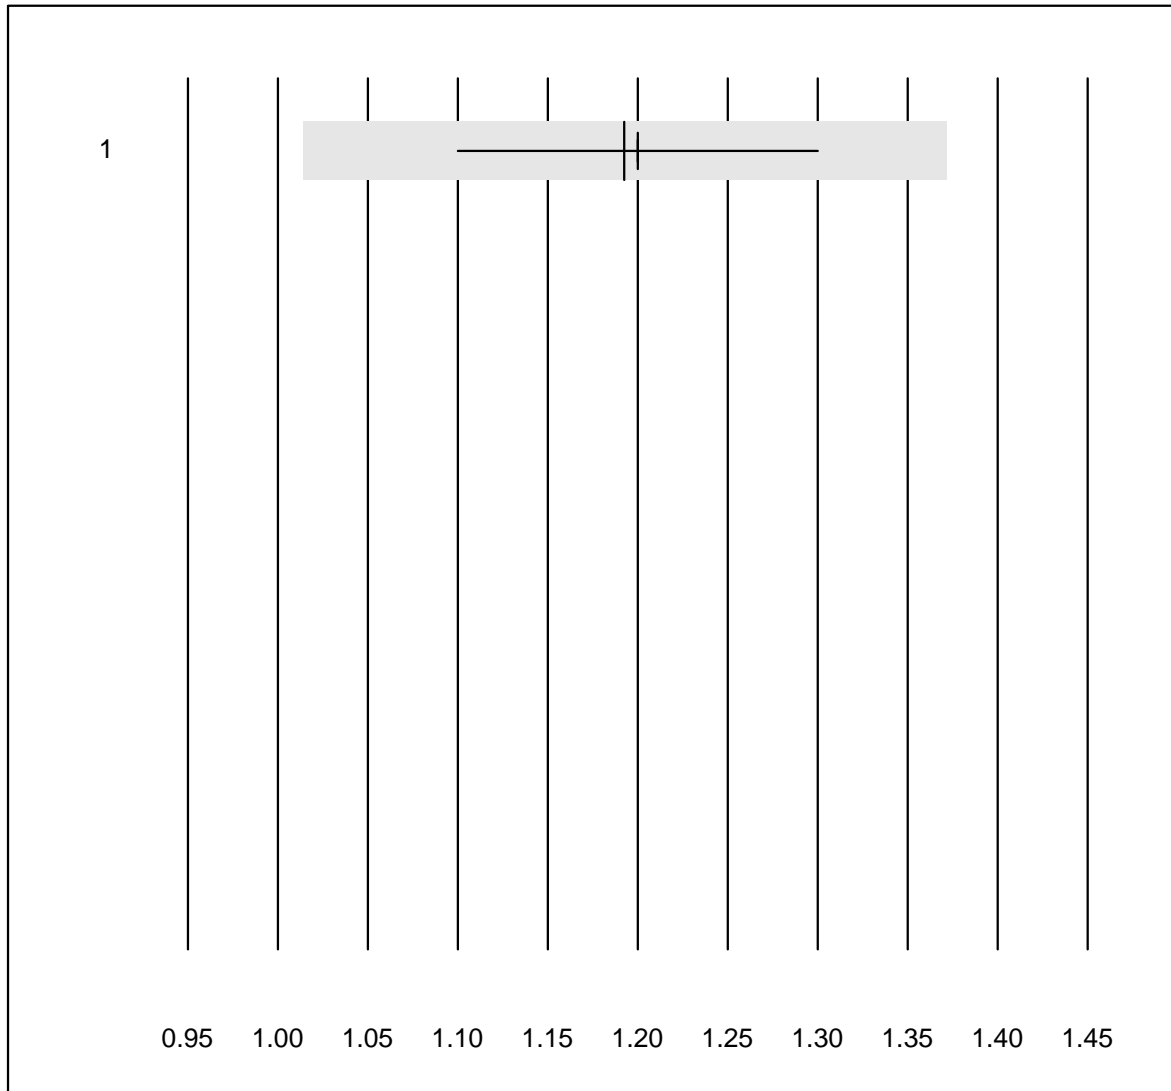


Tolérance QUALAB : 15 %

INR CoaguChek ()

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	CoaguChek Pro II	265	100.0	0.0	0.0	1.2	2.7	e

Quick N

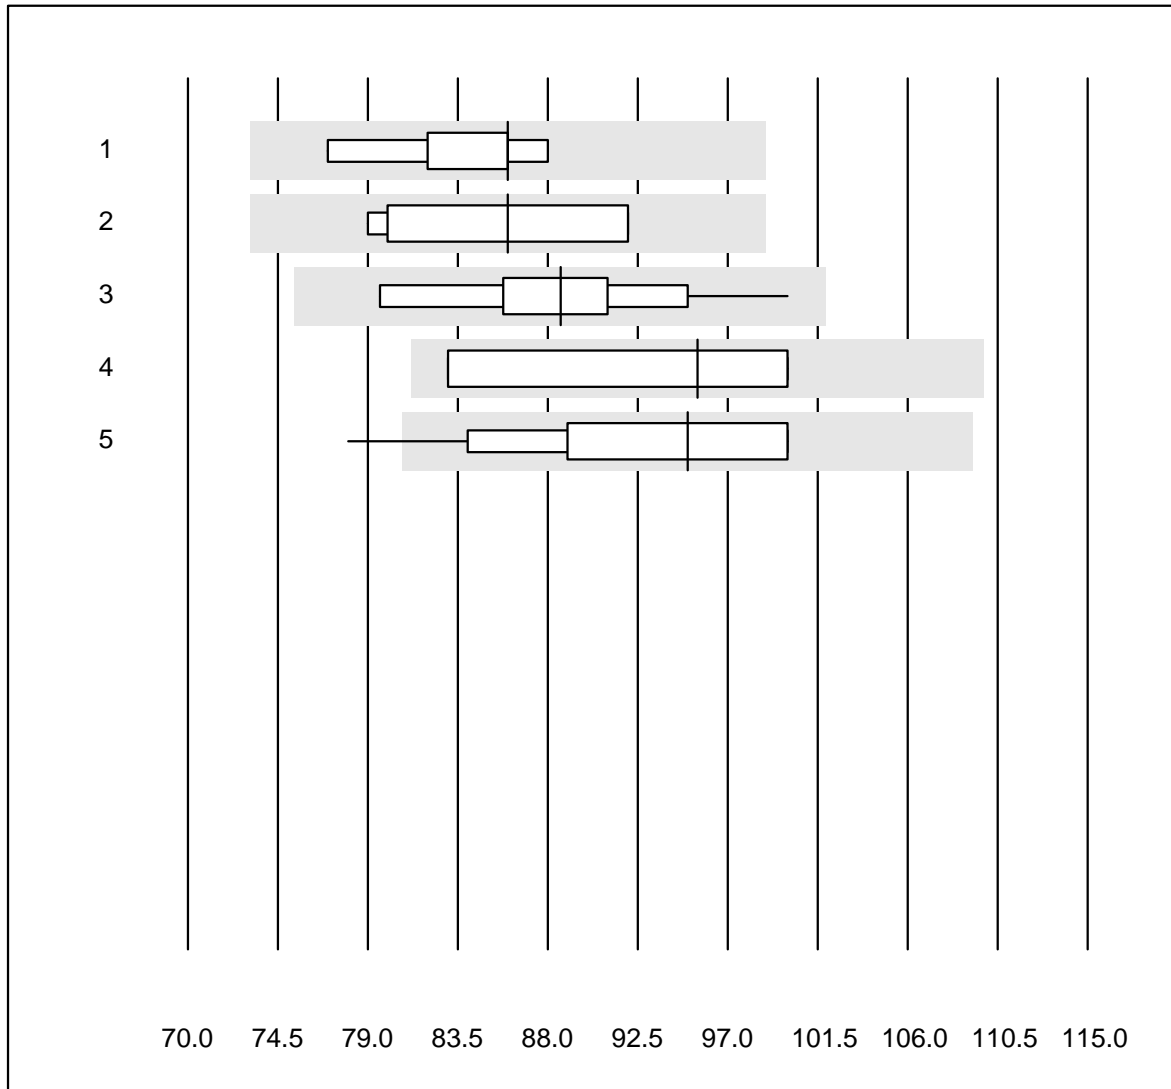


Tolérance QUALAB : 15 %

Quick N (%)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Neoplastin R	7	100.0	0.0	0.0	86	4.4	e
2 Neoplastin Plus	5	100.0	0.0	0.0	86	7.6	a
3 Innovin	10	100.0	0.0	0.0	89	6.6	e*
4 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	96	8.8	e*
5 Recombiplastin 2G	16	93.7	6.3	0.0	95	7.5	e*

Fibrinogen N

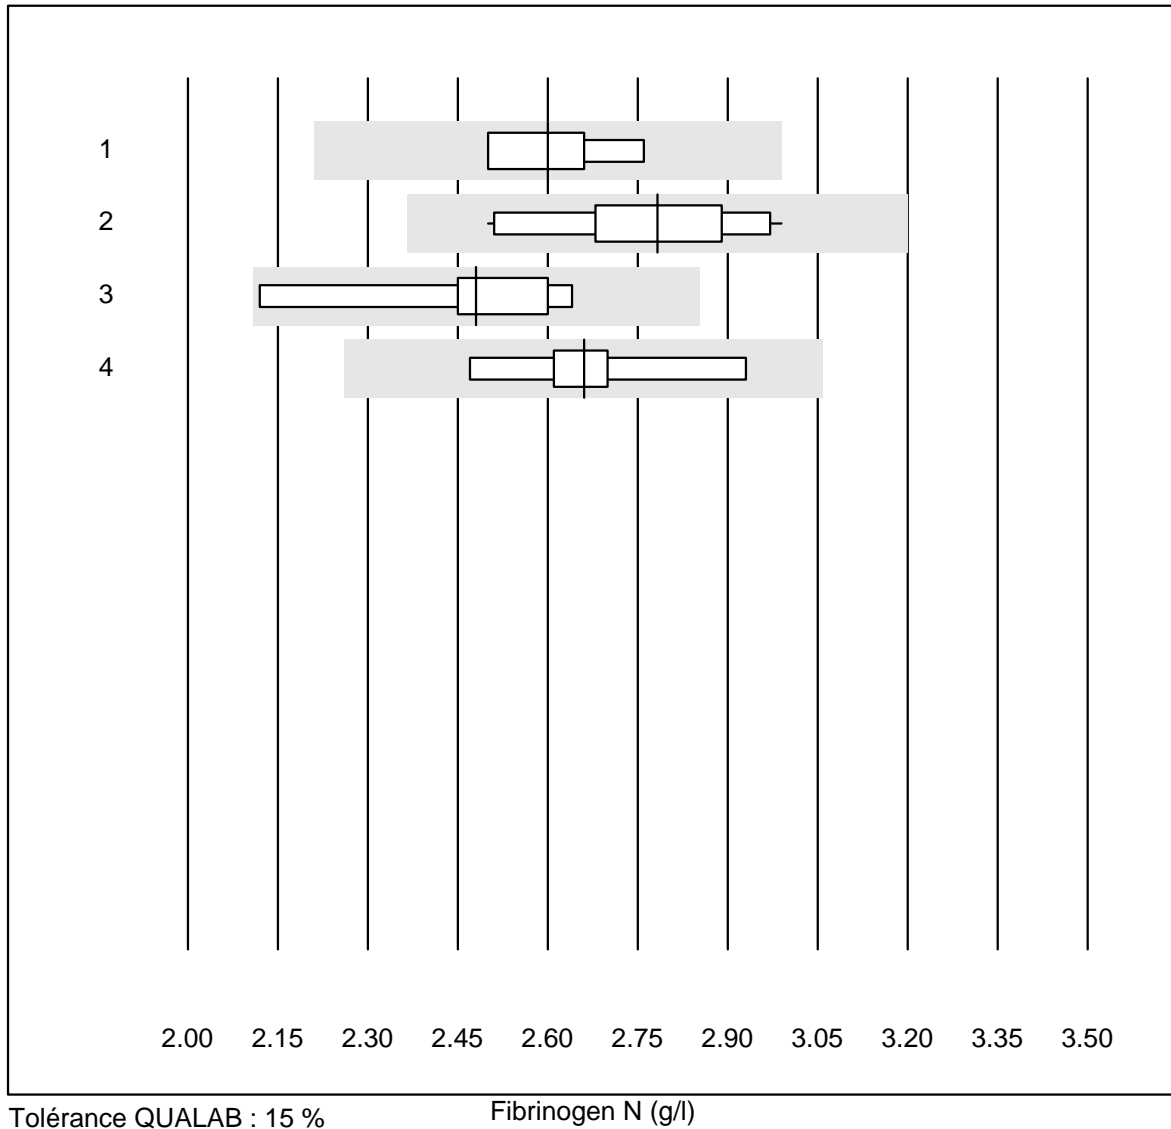


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Siemens Thrombin	7	100.0	0.0	0.0	2.60	3.7	e
2	Stago/STA	11	100.0	0.0	0.0	2.78	6.0	e*
3	Fibrinogen Q.F.A.	9	100.0	0.0	0.0	2.48	6.7	e*
4	Fib Clauss (IL)	5	100.0	0.0	0.0	2.66	6.3	e*

aPTT N

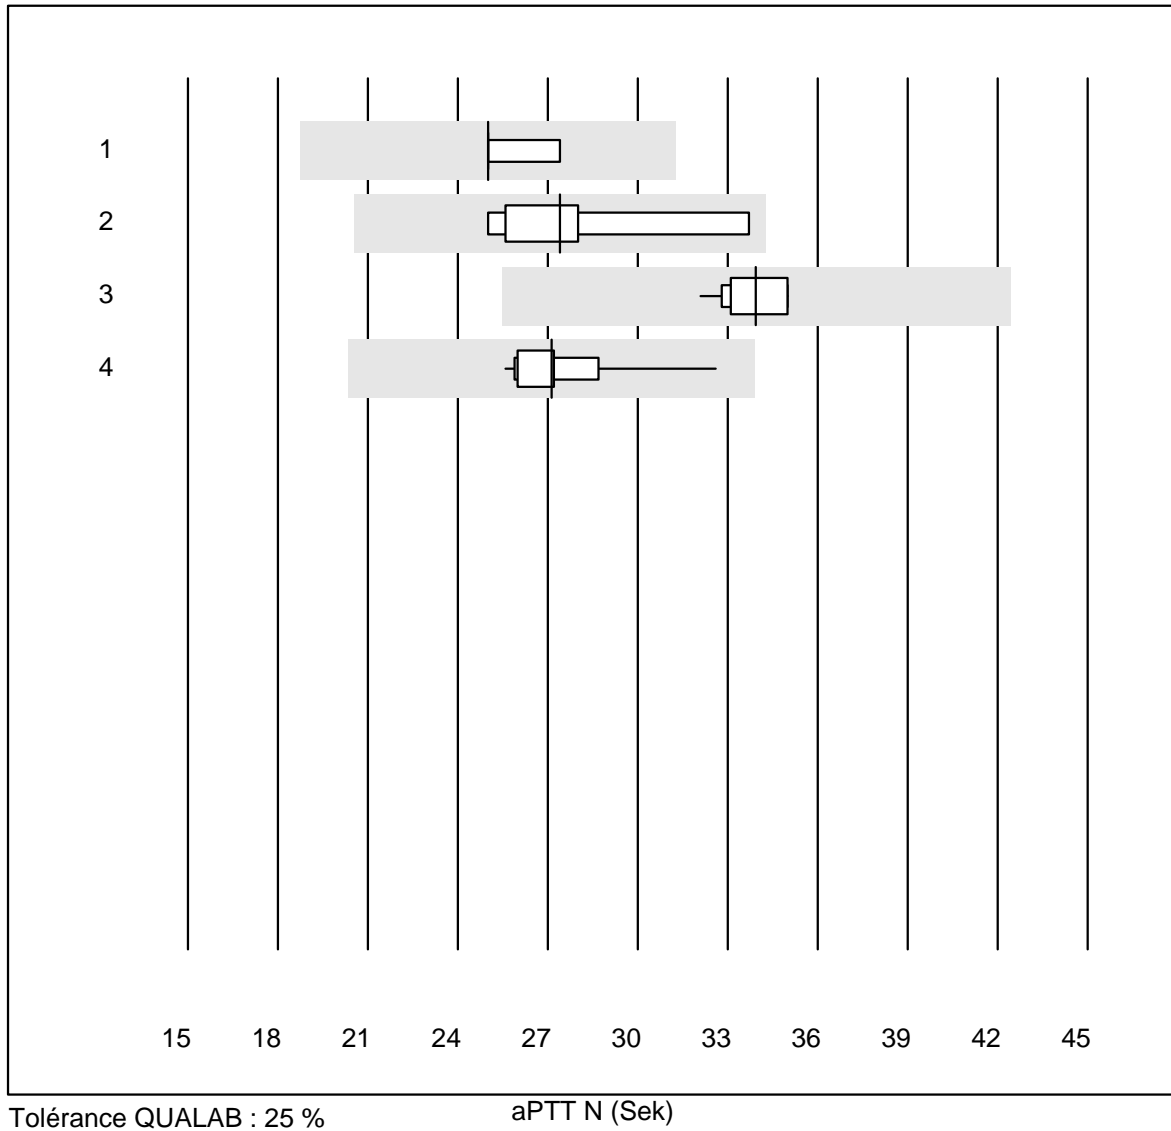

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Actin FS	4	100.0	0.0	0.0	25.0	4.7	e
2 Autres méthodes	6	100.0	0.0	0.0	27.4	11.1	e*
3 Stago/STA	12	100.0	0.0	0.0	33.9	2.9	e
4 aPTT-SP	13	100.0	0.0	0.0	27.1	6.8	e

Quick H

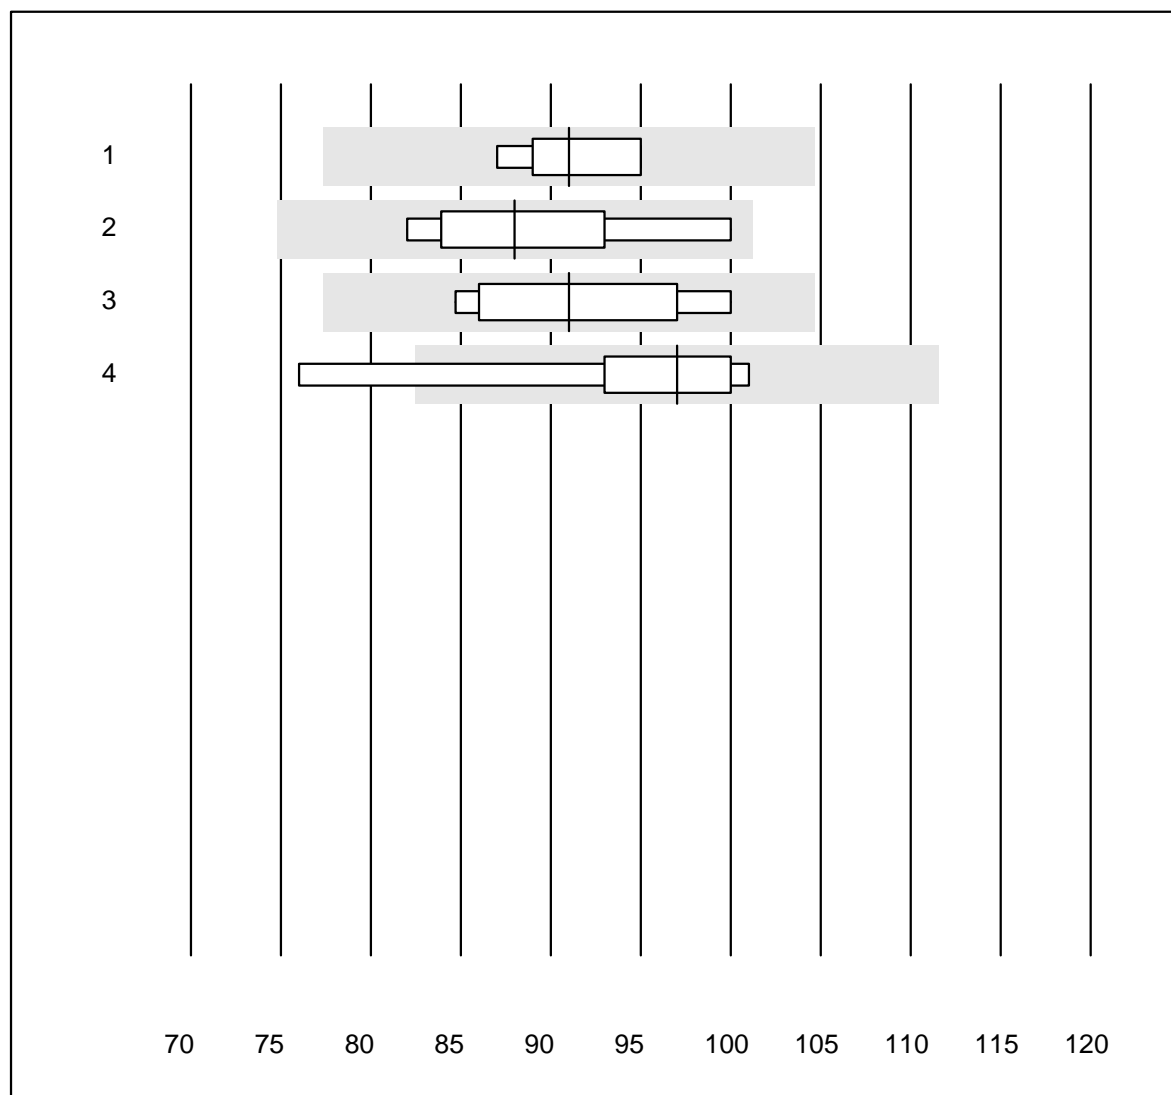


Tolérance QUALAB : 15 %

Quick H (%)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Neoplastin R	7	100.0	0.0	0.0	91	3.4	e
2 Innovin	7	100.0	0.0	0.0	88	6.9	e*
3 toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	91	6.9	e*
4 Recombiplastin 2G	9	88.9	11.1	0.0	97	8.8	e*

Fibrinogen H

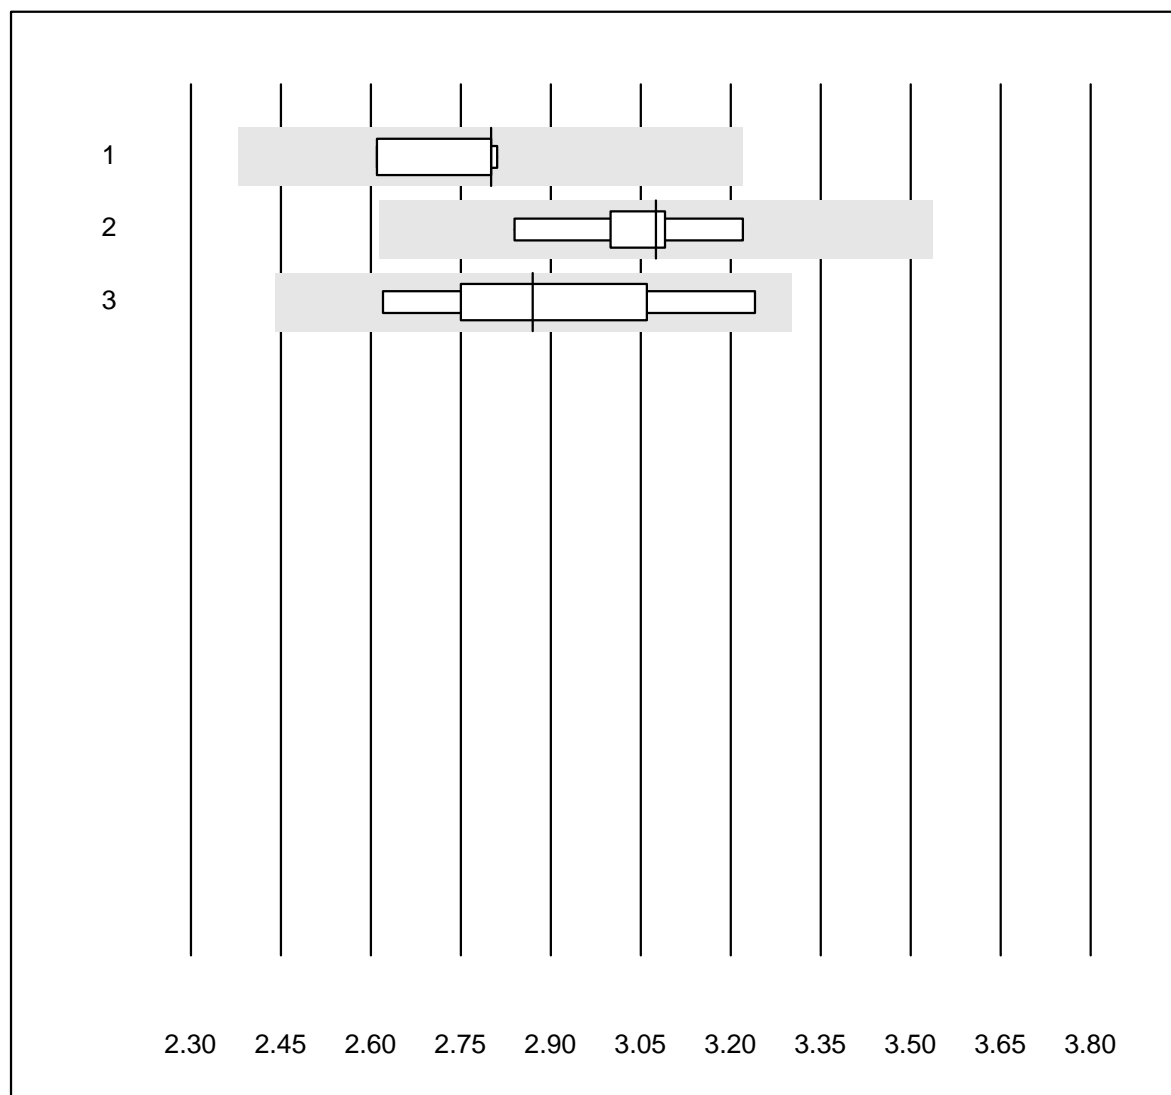


Tolérance QUALAB : 15 %

Fibrinogen H (g/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Siemens Thrombin	4	100.0	0.0	0.0	2.80	3.5	e
2	Stago/STA	8	100.0	0.0	0.0	3.08	3.5	e
3	Fib Clauss (IL)	8	100.0	0.0	0.0	2.87	7.4	e*

aPTT H

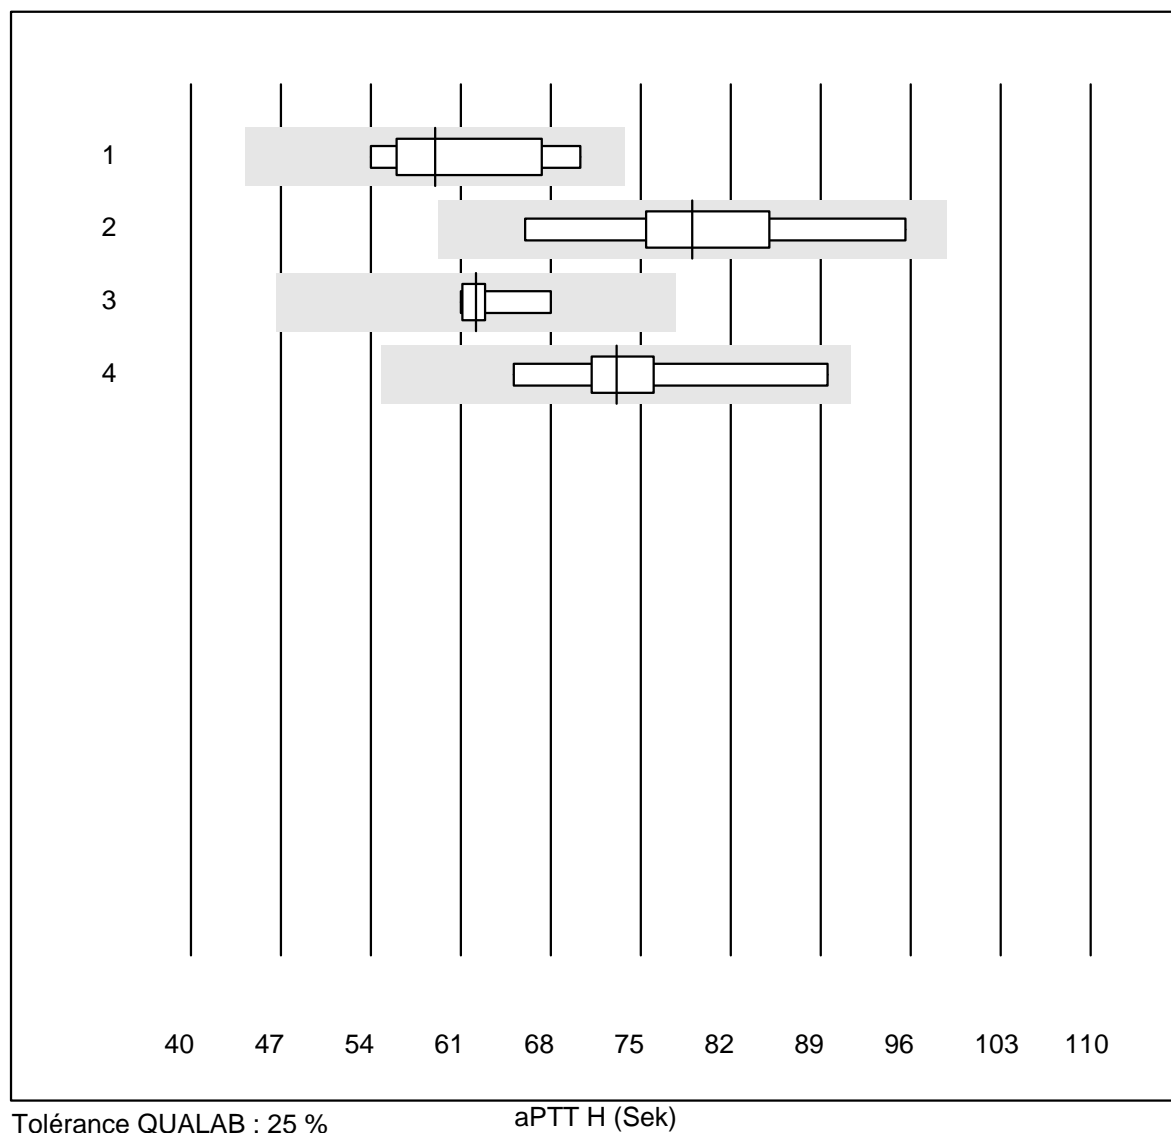

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Actin FS	7	100.0	0.0	0.0	59.0	9.9	e*
2 Autres méthodes	6	100.0	0.0	0.0	79.0	12.4	e*
3 Stago/STA	5	100.0	0.0	0.0	62.2	4.6	e
4 aPTT-SP	7	100.0	0.0	0.0	73.1	9.9	e*

D-Dimères NC

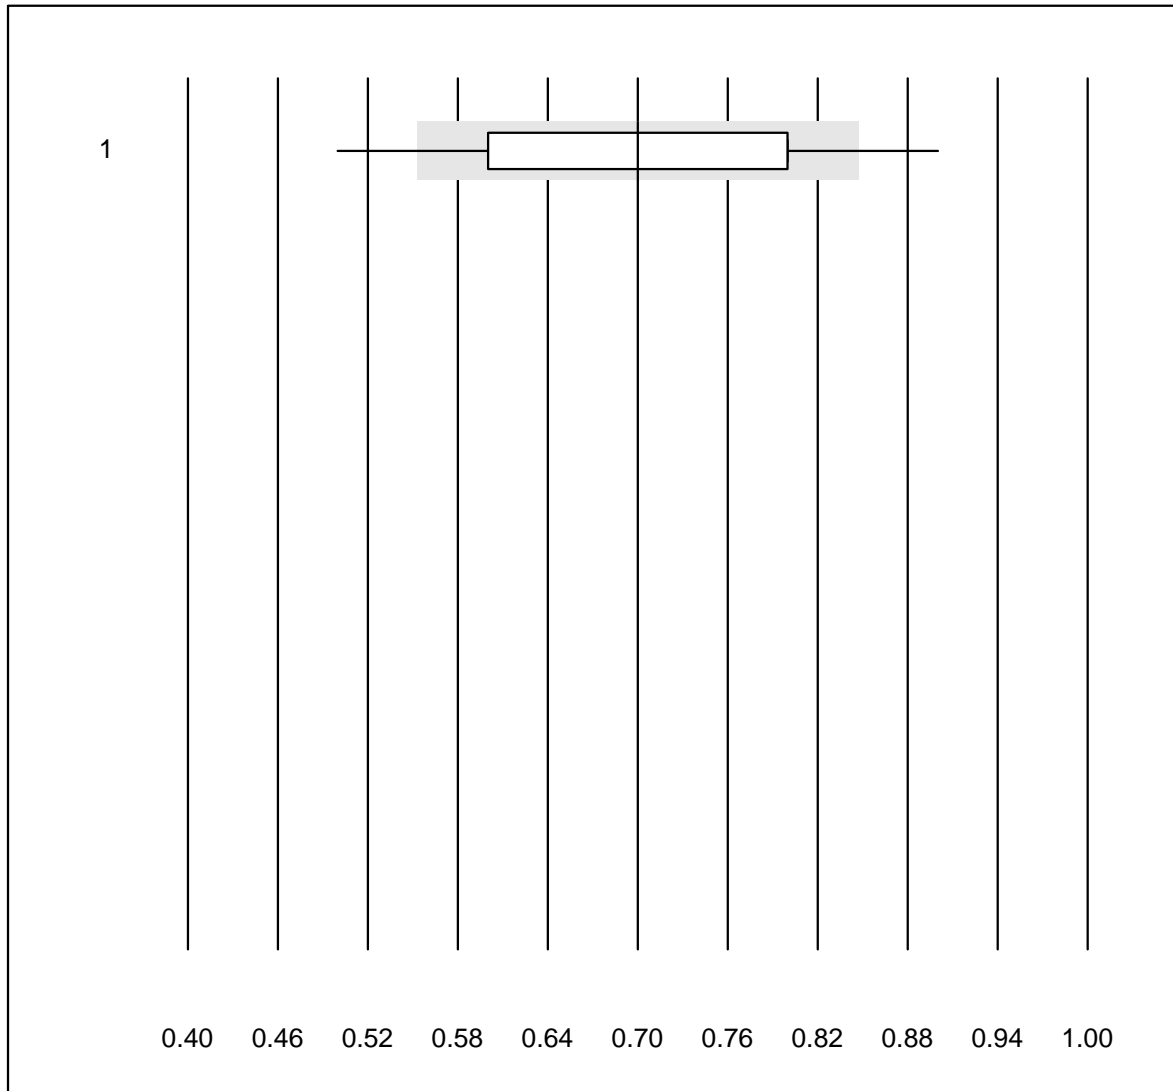


Tolérance QUALAB : 21 %

D-Dimères NC (mg/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 NycoCard	18	61.1	11.1	27.8	0.70	15.4	e*

D-Dimères

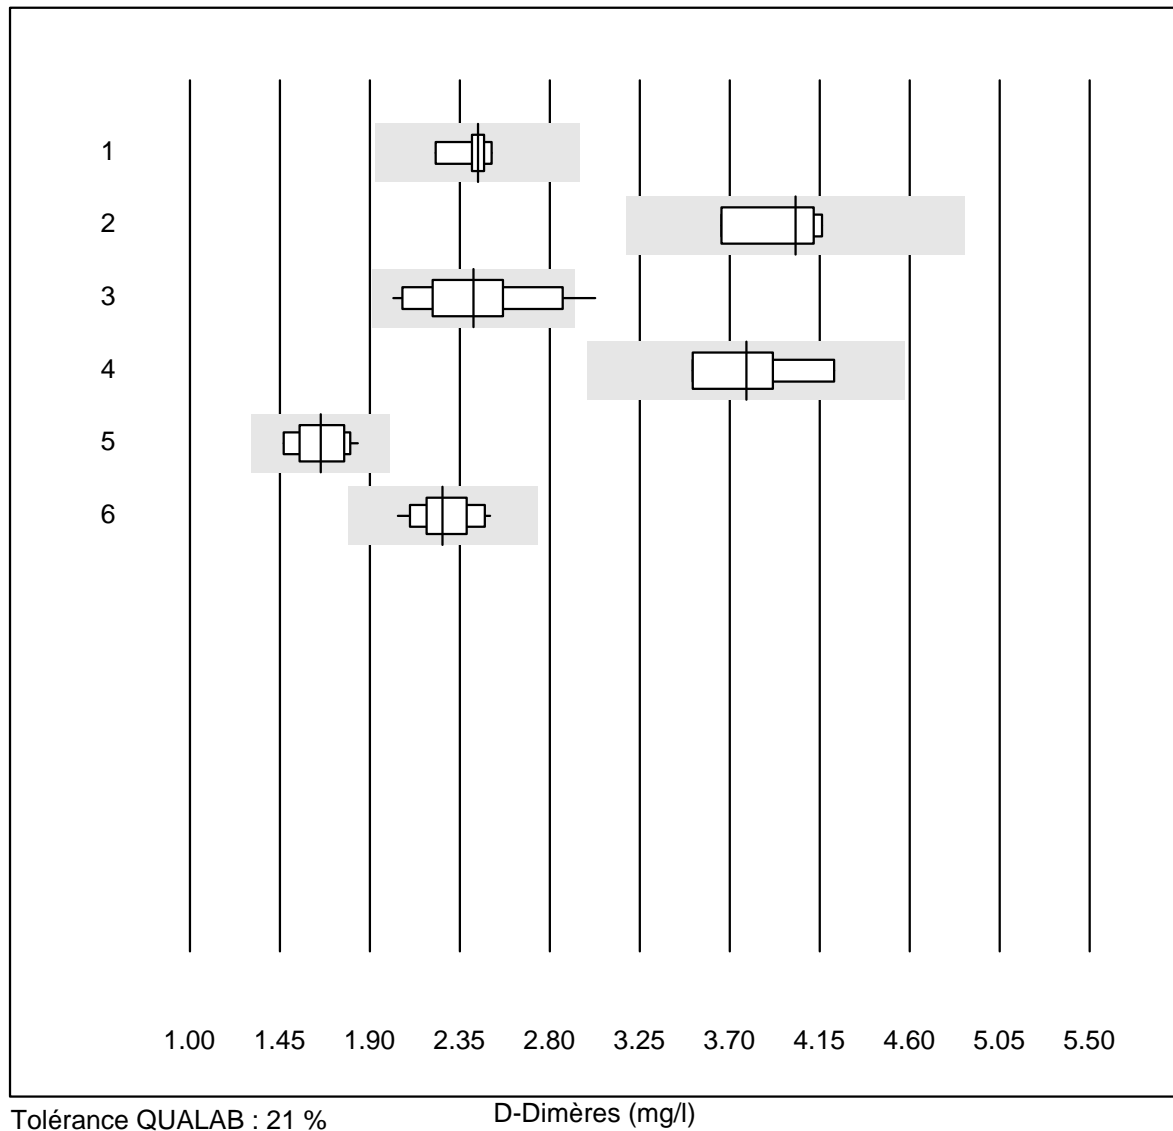


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 STA Liatest	9	100.0	0.0	0.0	2.44	3.6	e
2 Siemens Innovance	4	100.0	0.0	0.0	4.03	5.7	e*
3 Eurolyser	22	68.2	4.5	27.3	2.42	11.8	e*
4 ACL	4	100.0	0.0	0.0	3.78	8.1	e*
5 AQT 90 FLEX	10	100.0	0.0	0.0	1.65	7.6	e
6 VIDAS	18	100.0	0.0	0.0	2.26	5.9	e

CoaguChek APTT

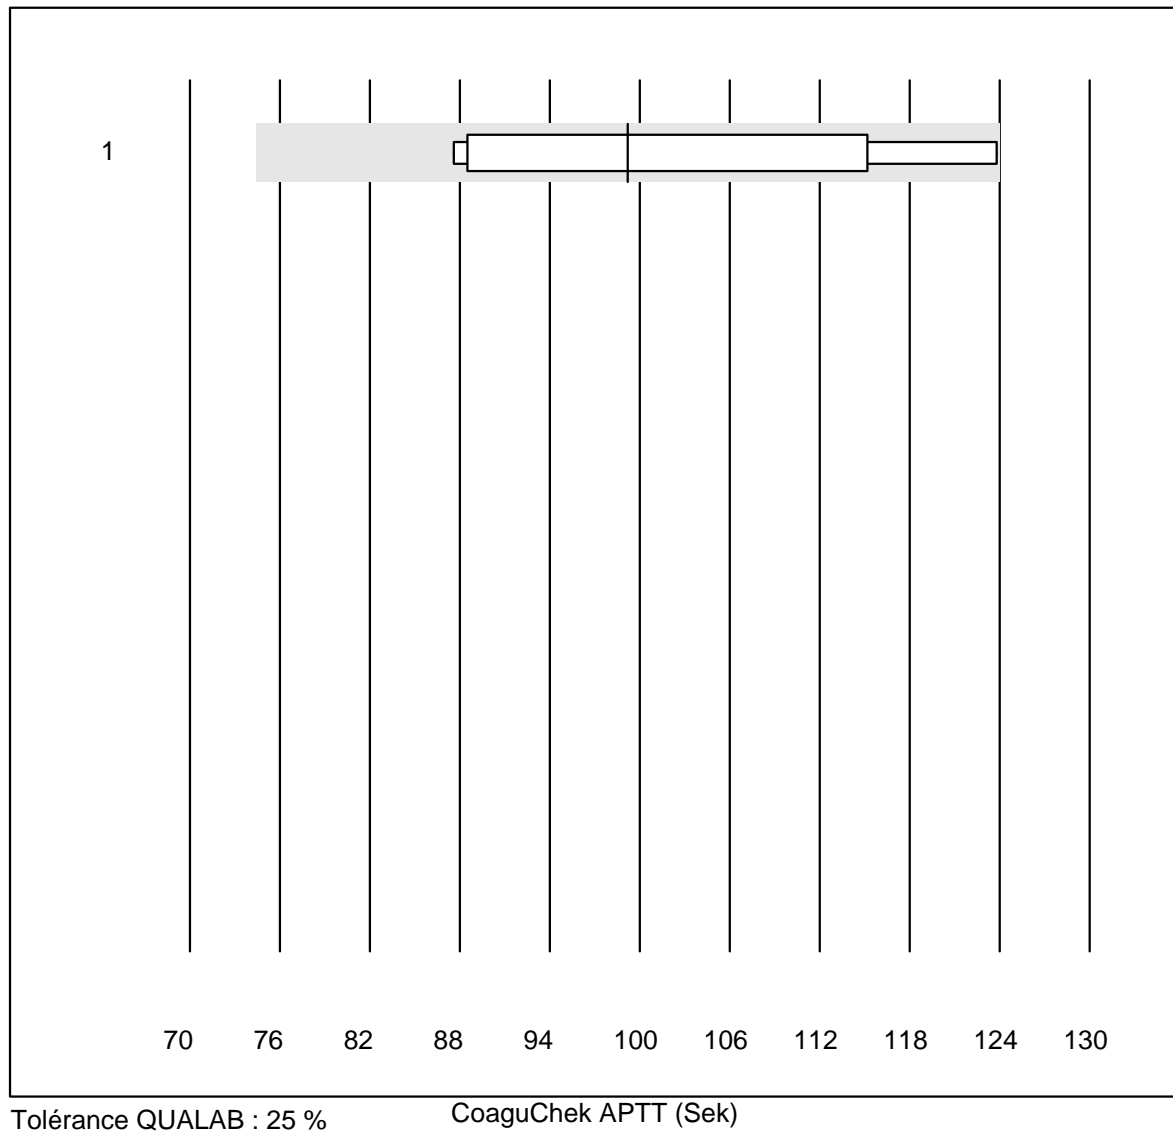

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 CoaguChek Pro II	7	100.0	0.0	0.0	99.2	14.1	e*

INR CCXS

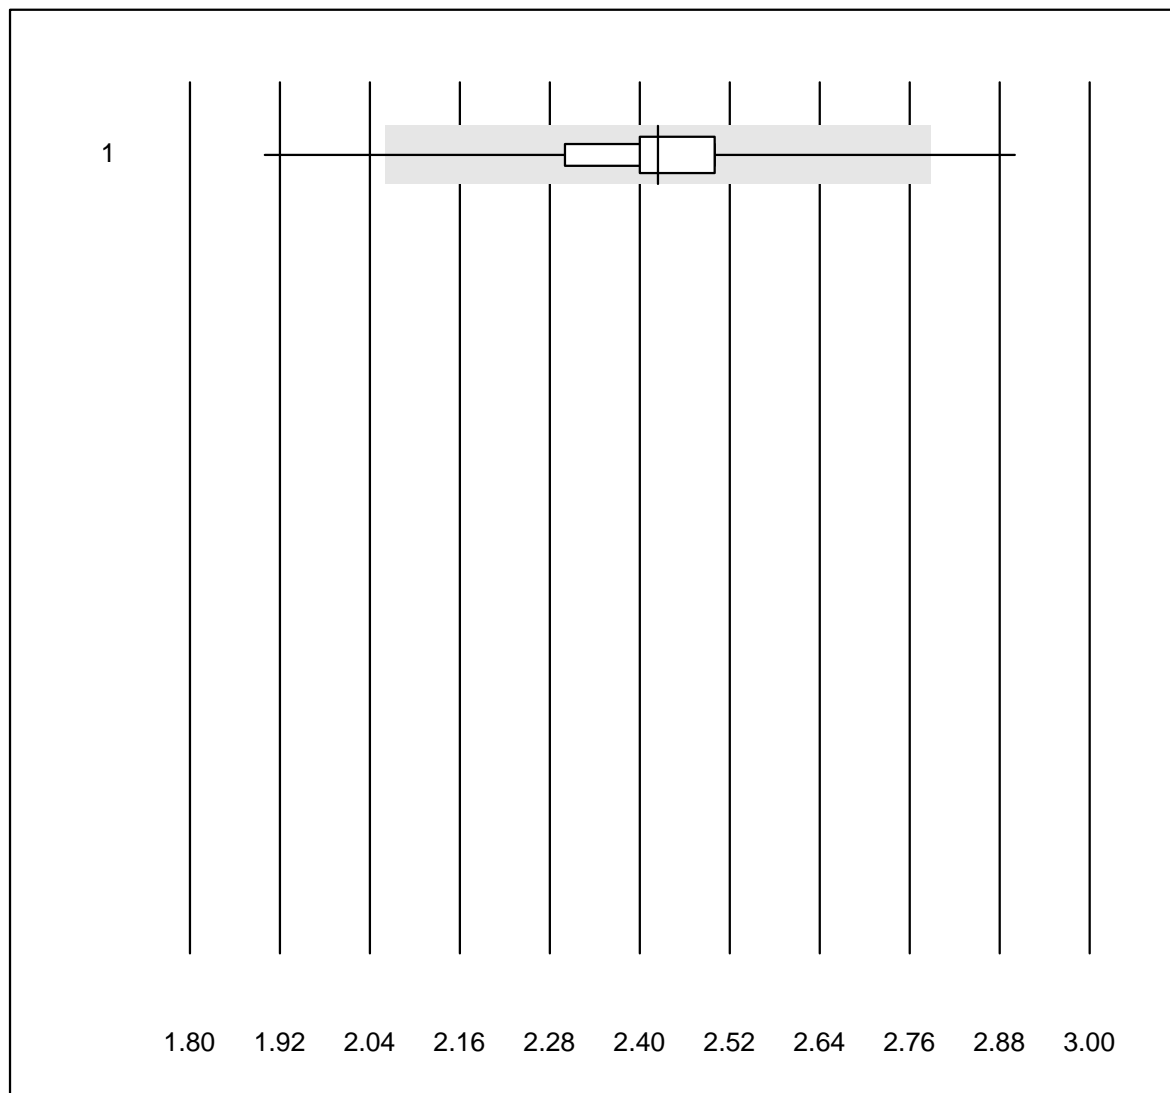


Tolérance QUALAB : 15 %

INR CCXS ()


No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 CoaguChek XS	2124	99.1	0.6	0.3	2.4	4.7	e

INR HC

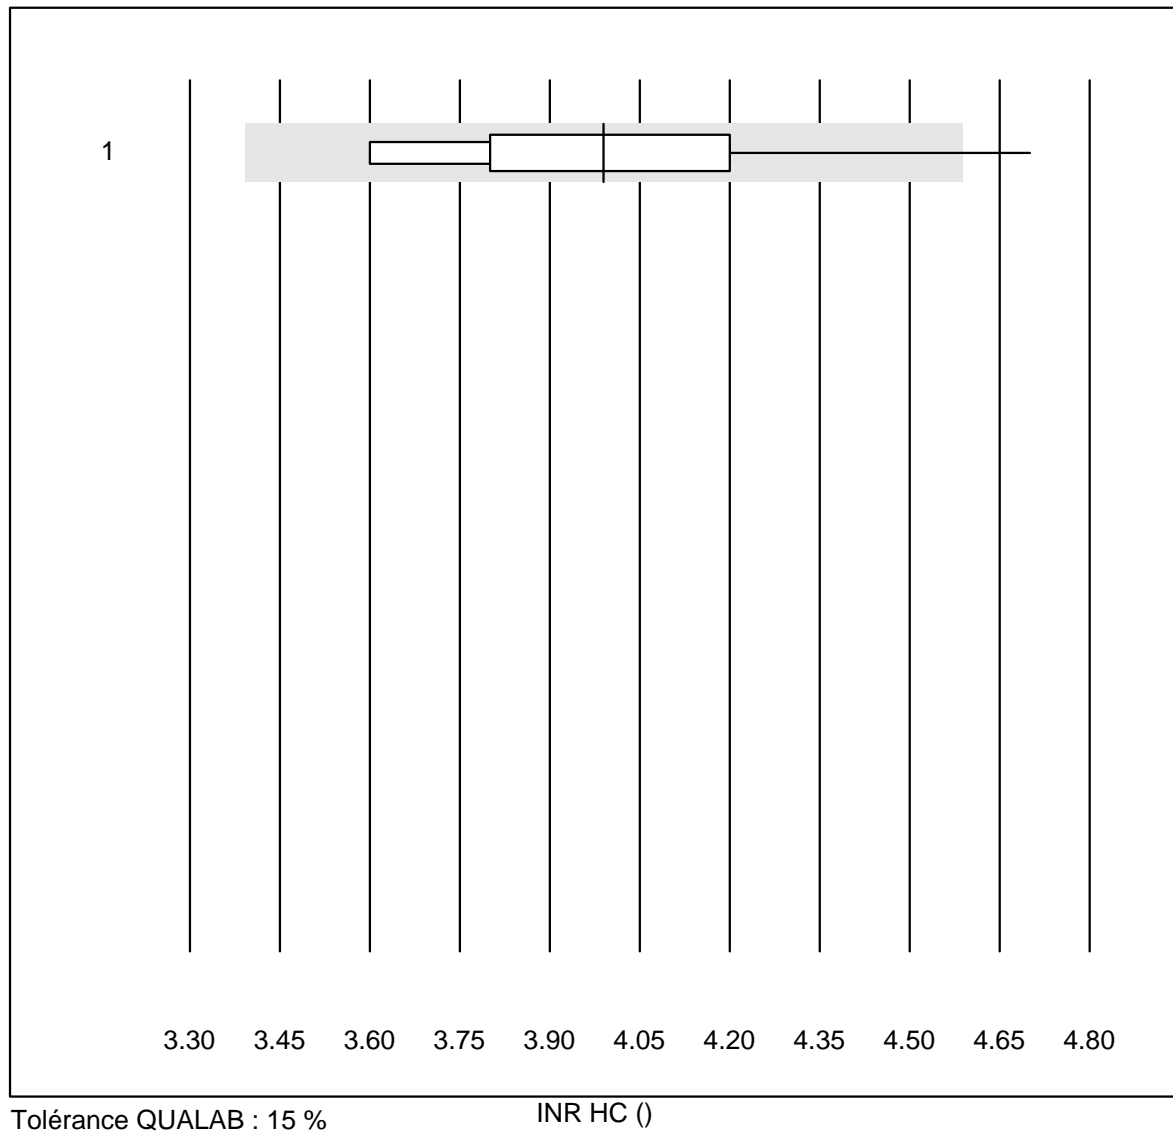


No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Hemochron j.	11	81.8	9.1	9.1	4.0	8.1	e*

INR MI

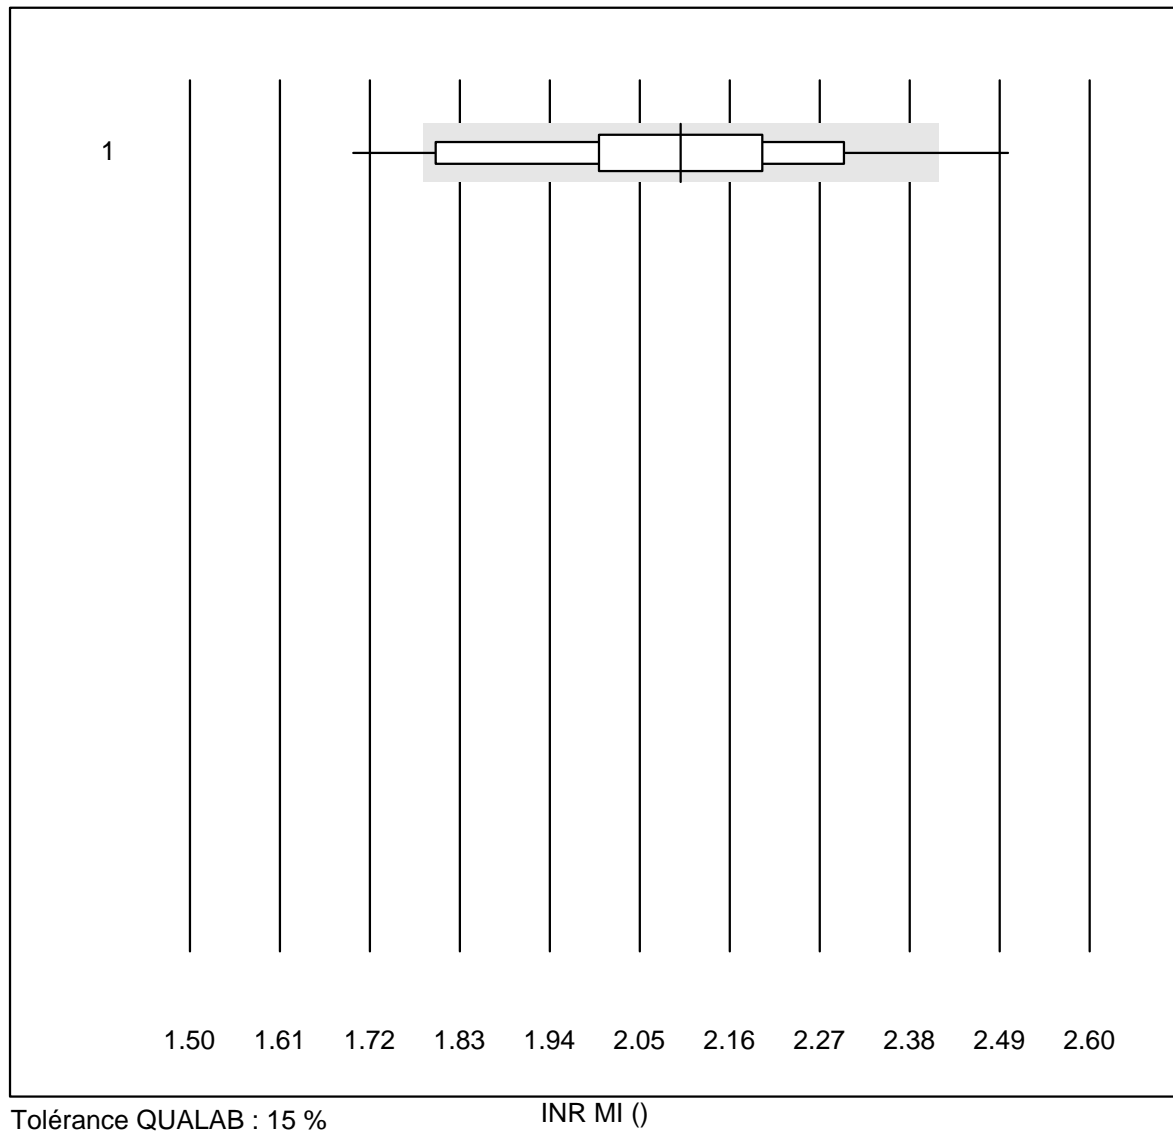

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 MicroINR	107	83.2	4.7	12.1	2.1	8.2	e

INR Xprecia

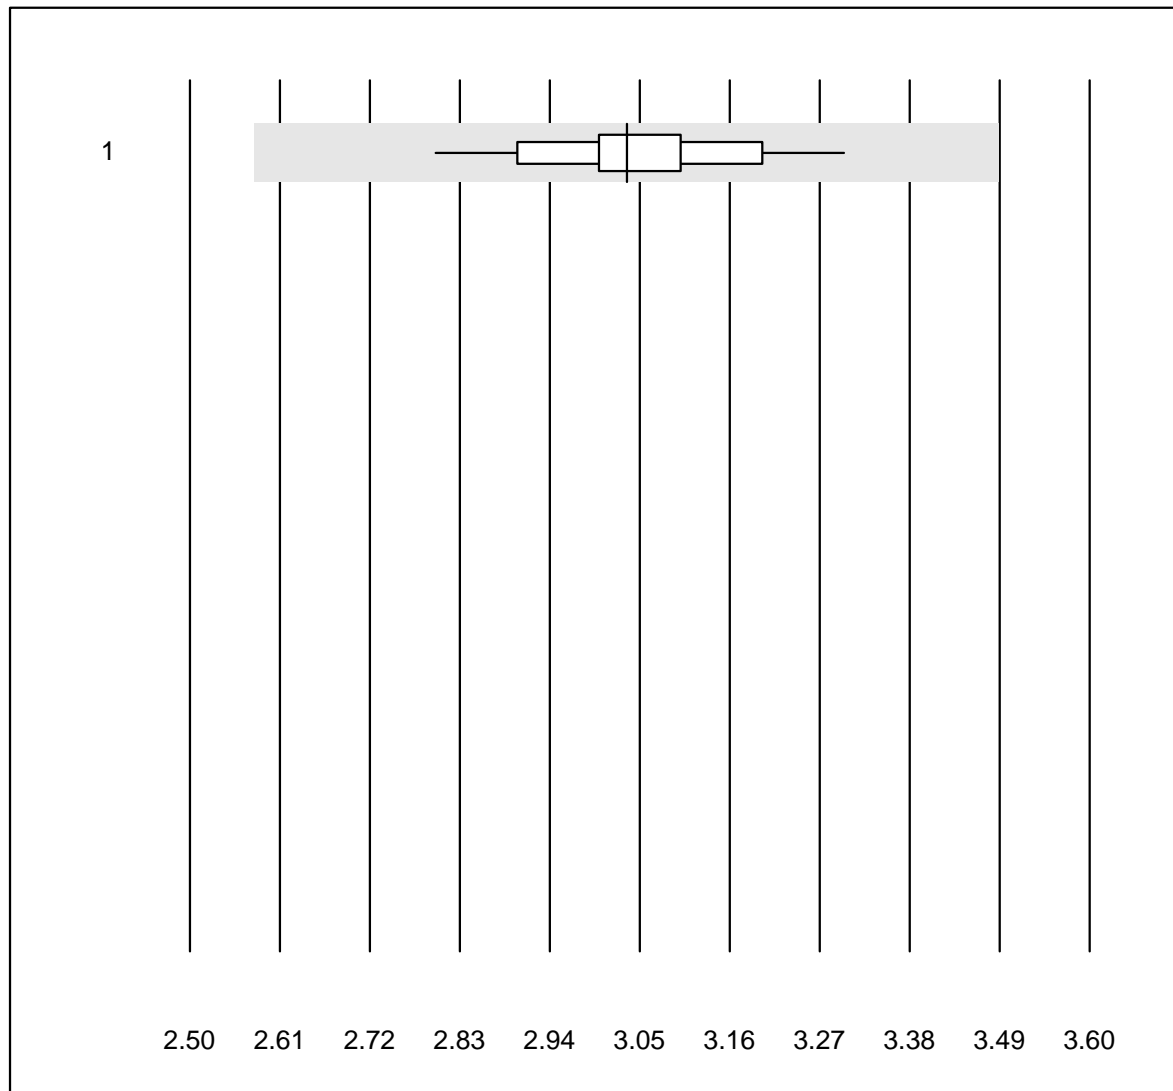


Tolérance QUALAB : 15 %

INR Xprecia ()


No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Xprecia	56	100.0	0.0	0.0	3.0	3.9	e

Hémoglobine

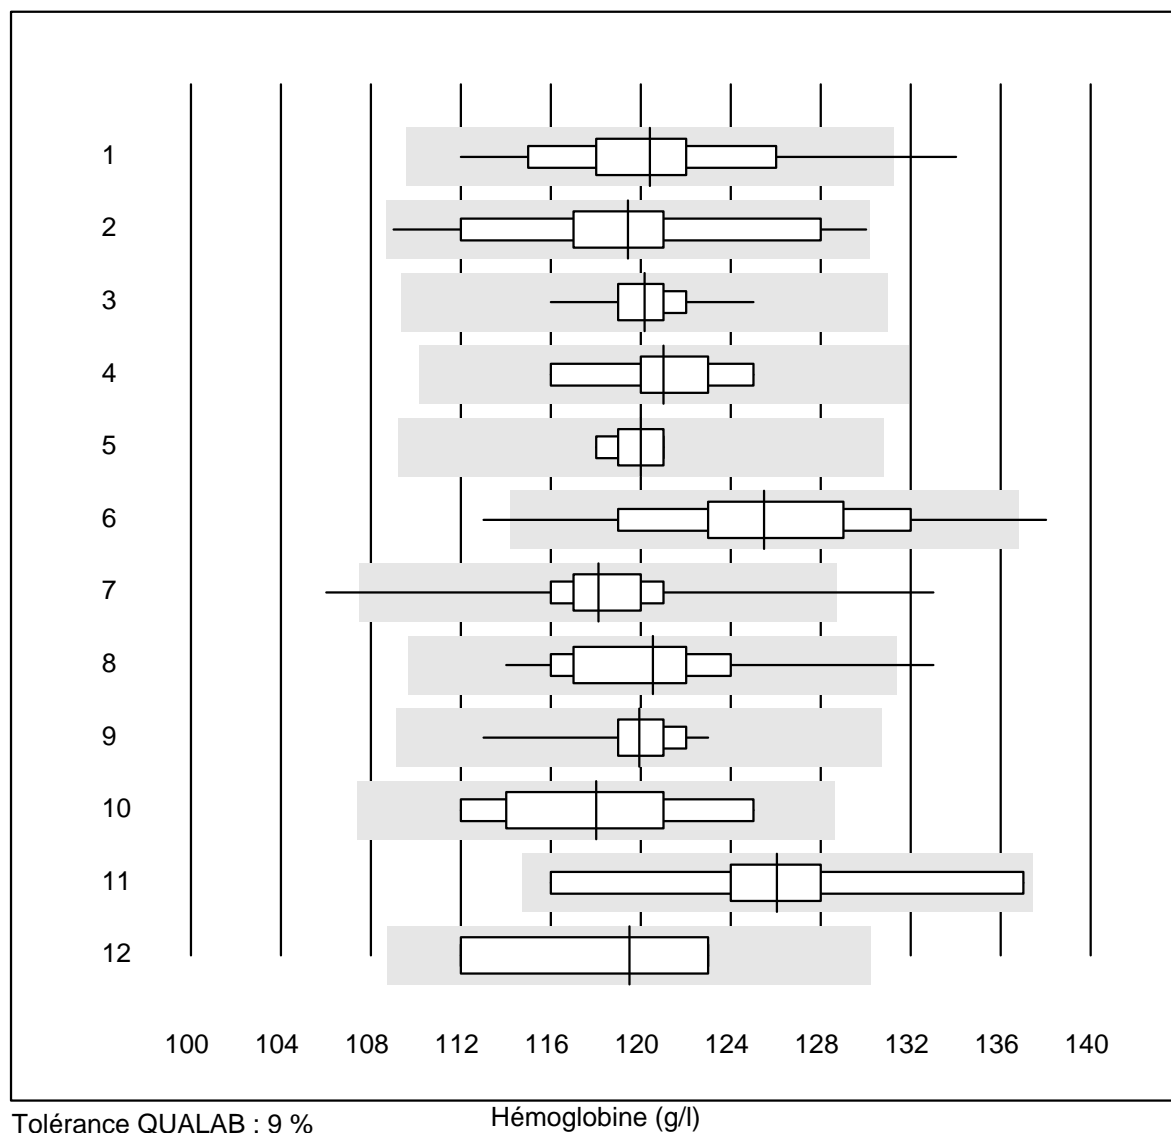


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Automate	35	91.4	2.9	5.7	120.4	3.6	e
2	Cyanmethémoglobine	37	94.6	0.0	5.4	119.4	4.4	e
3	System X	39	100.0	0.0	0.0	120.2	1.4	e
4	Advia 120	9	100.0	0.0	0.0	121.0	2.2	e
5	ABX Pentra	9	100.0	0.0	0.0	120.0	1.1	e
6	Reflotron	53	90.5	5.7	3.8	125.5	4.3	e
7	Hemocue	371	97.0	1.1	1.9	118.1	2.4	e
8	Dr. Lange	15	66.6	6.7	26.7	120.5	4.1	e
9	Hemocontrol	14	100.0	0.0	0.0	119.9	1.9	e
10	Eurolyser	7	85.7	0.0	14.3	118.0	4.0	e*
11	DiaSpect	10	90.0	0.0	10.0	126.1	4.6	e*
12	MS4	4	100.0	0.0	0.0	119.5	4.6	e*

Hémoglobine

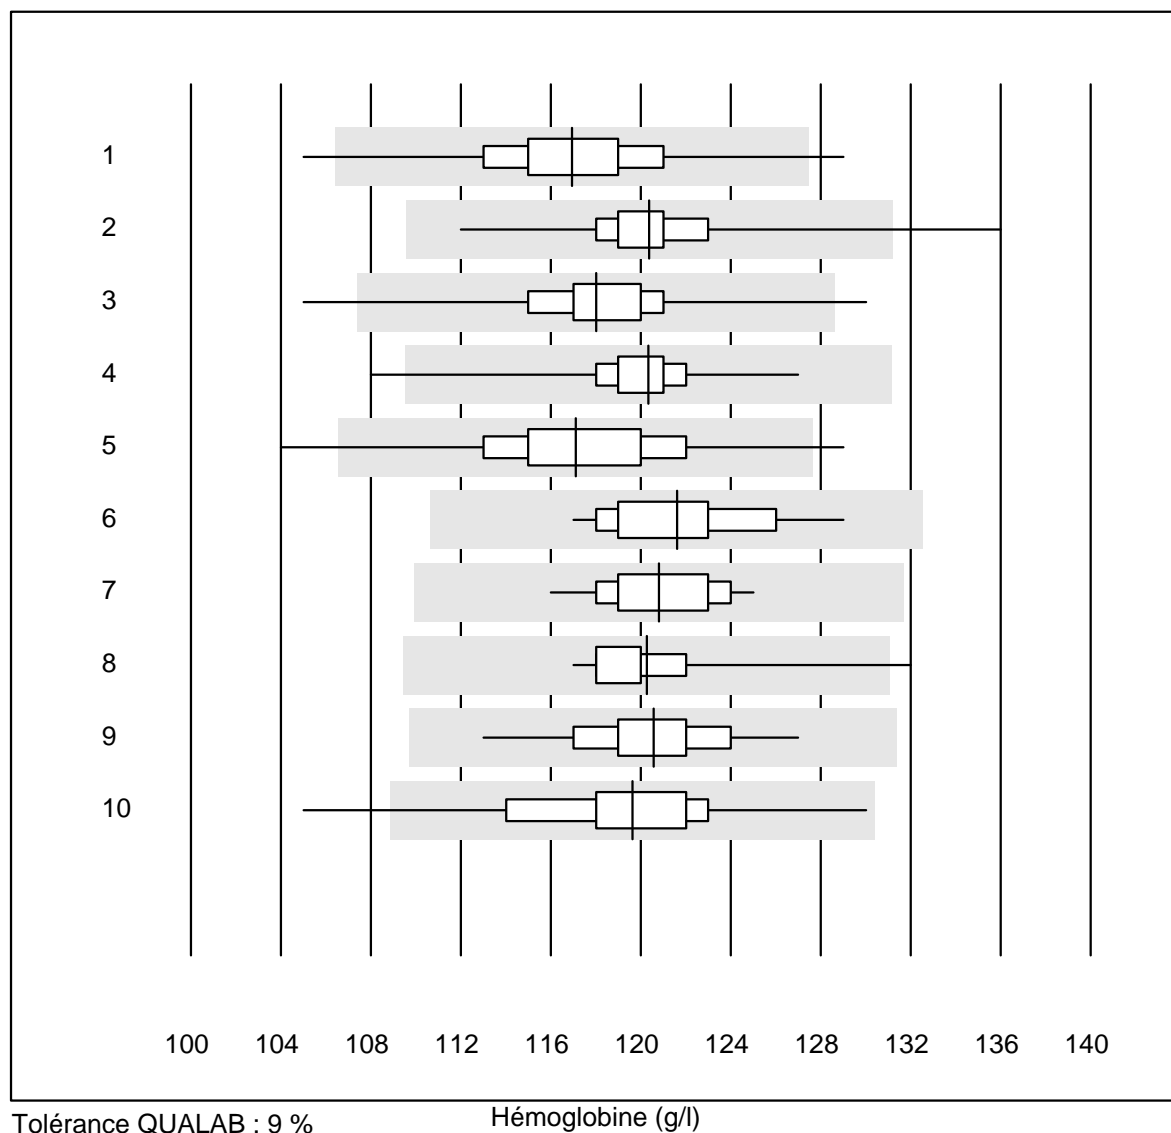

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Micros 60	271	96.0	0.7	3.3	116.9	2.8	e
2	Sysmex KX21	324	98.2	0.6	1.2	120.4	1.9	e
3	Sysmex PochH - 100i	195	97.0	1.5	1.5	118.0	2.5	e
4	Sysmex XP 300	404	98.3	0.2	1.5	120.3	1.5	e
5	Mythic	269	95.5	2.6	1.9	117.1	3.4	e
6	Swelab	50	100.0	0.0	0.0	121.6	2.4	e
7	Abacus Junior	11	100.0	0.0	0.0	120.8	2.2	e
8	Medonic	11	90.9	9.1	0.0	120.3	3.4	e
9	Nihon Kohden Celltac	68	98.5	0.0	1.5	120.6	2.3	e
10	Samsung HC10	45	95.6	2.2	2.2	119.6	3.7	e

Hématocrite

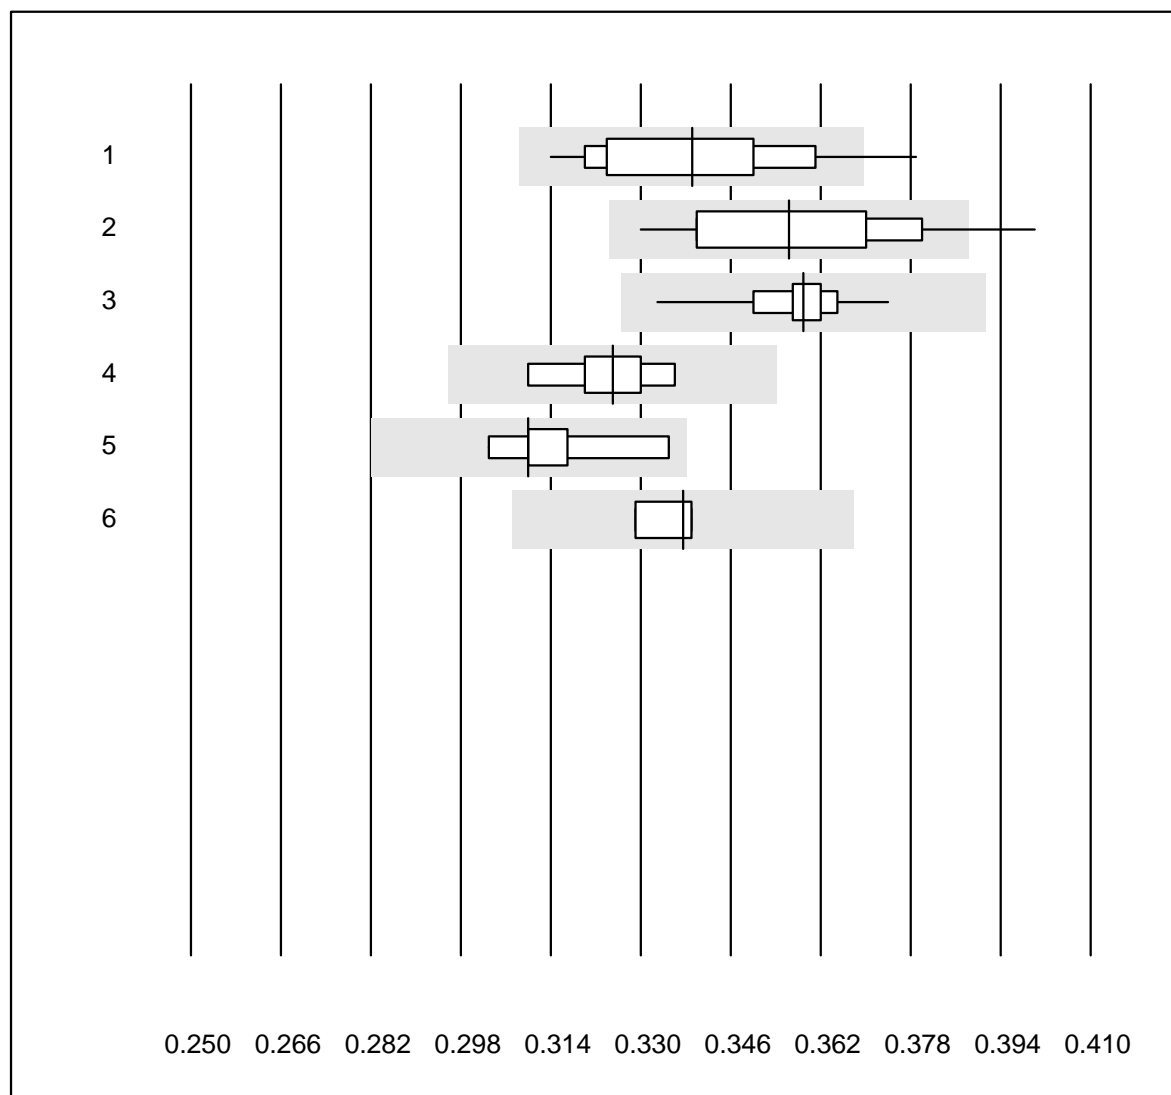


Tolérance QUALAB : 9 %

Hématocrite (l/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Automate	29	86.2	6.9	6.9	0.34	5.2	e
2	Centrifuge	11	90.9	9.1	0.0	0.36	5.7	e*
3	Sysmex X	39	100.0	0.0	0.0	0.36	2.1	e
4	Advia 120	9	100.0	0.0	0.0	0.33	2.5	e
5	ABX Pentra	9	100.0	0.0	0.0	0.31	3.0	e
6	MS4	4	75.0	0.0	25.0	0.34	1.5	e

Hématocrite

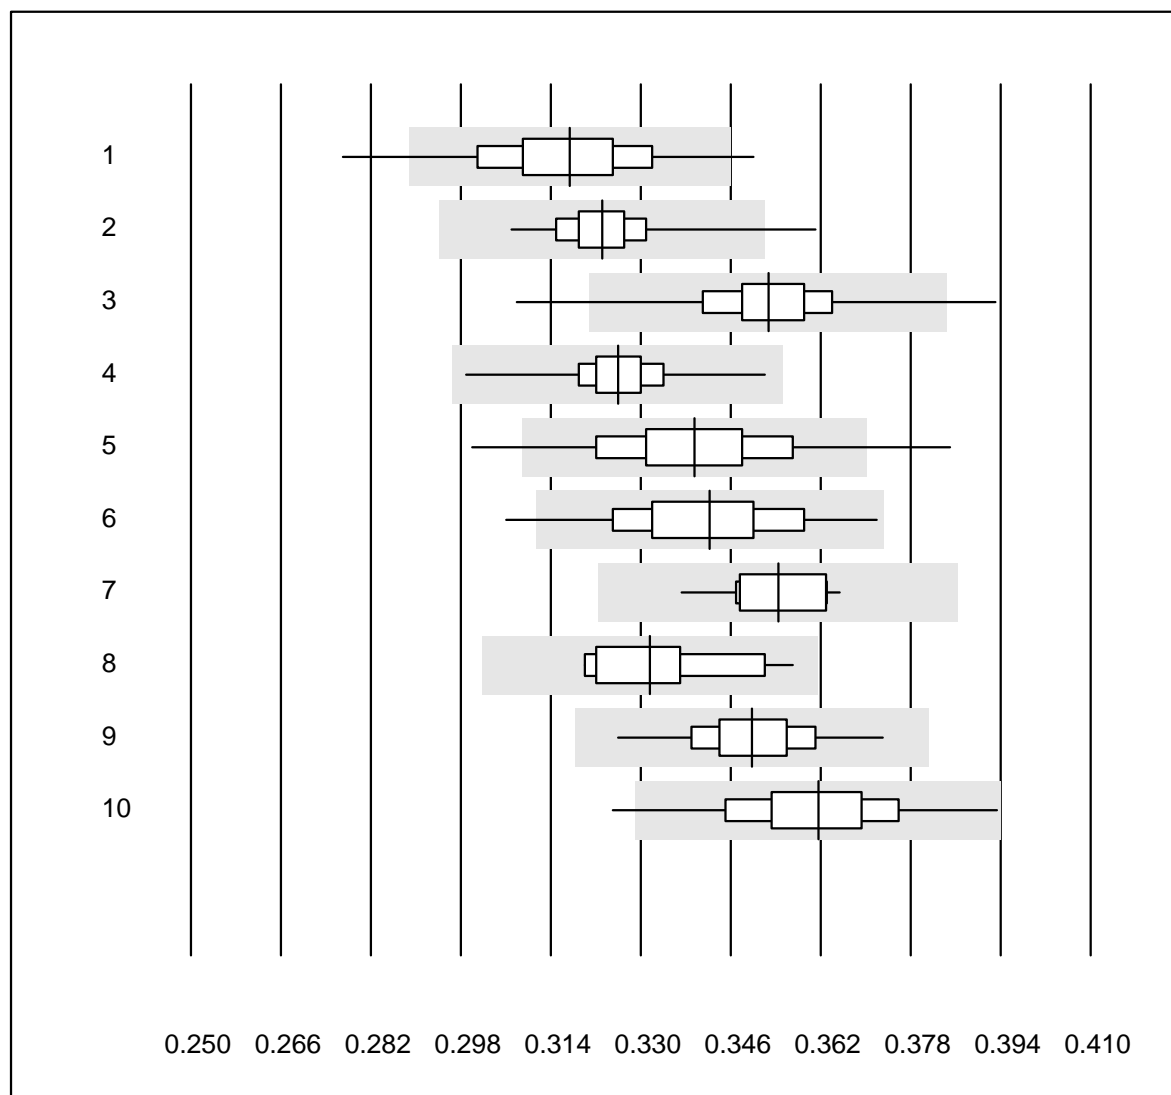


Tolérance QUALAB : 9 %

Hématocrite (l/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Micros 60	271	93.3	2.6	4.1	0.32	3.9	e
2	Sysmex KX21	326	98.5	0.3	1.2	0.32	2.2	e
3	Sysmex PochH - 100i	195	95.9	3.6	0.5	0.35	3.3	e
4	Sysmex XP 300	406	98.8	0.0	1.2	0.33	2.1	e
5	Mythic	270	94.4	3.7	1.9	0.34	4.0	e
6	Swelab	50	98.0	2.0	0.0	0.34	4.2	e
7	Abacus Junior	11	100.0	0.0	0.0	0.35	2.6	e
8	Medonic	11	90.9	0.0	9.1	0.33	3.9	e*
9	Nihon Kohden Celltac	68	98.5	0.0	1.5	0.35	2.6	e
10	Samsung HC10	45	93.4	2.2	4.4	0.36	3.5	e

Erythrocytes

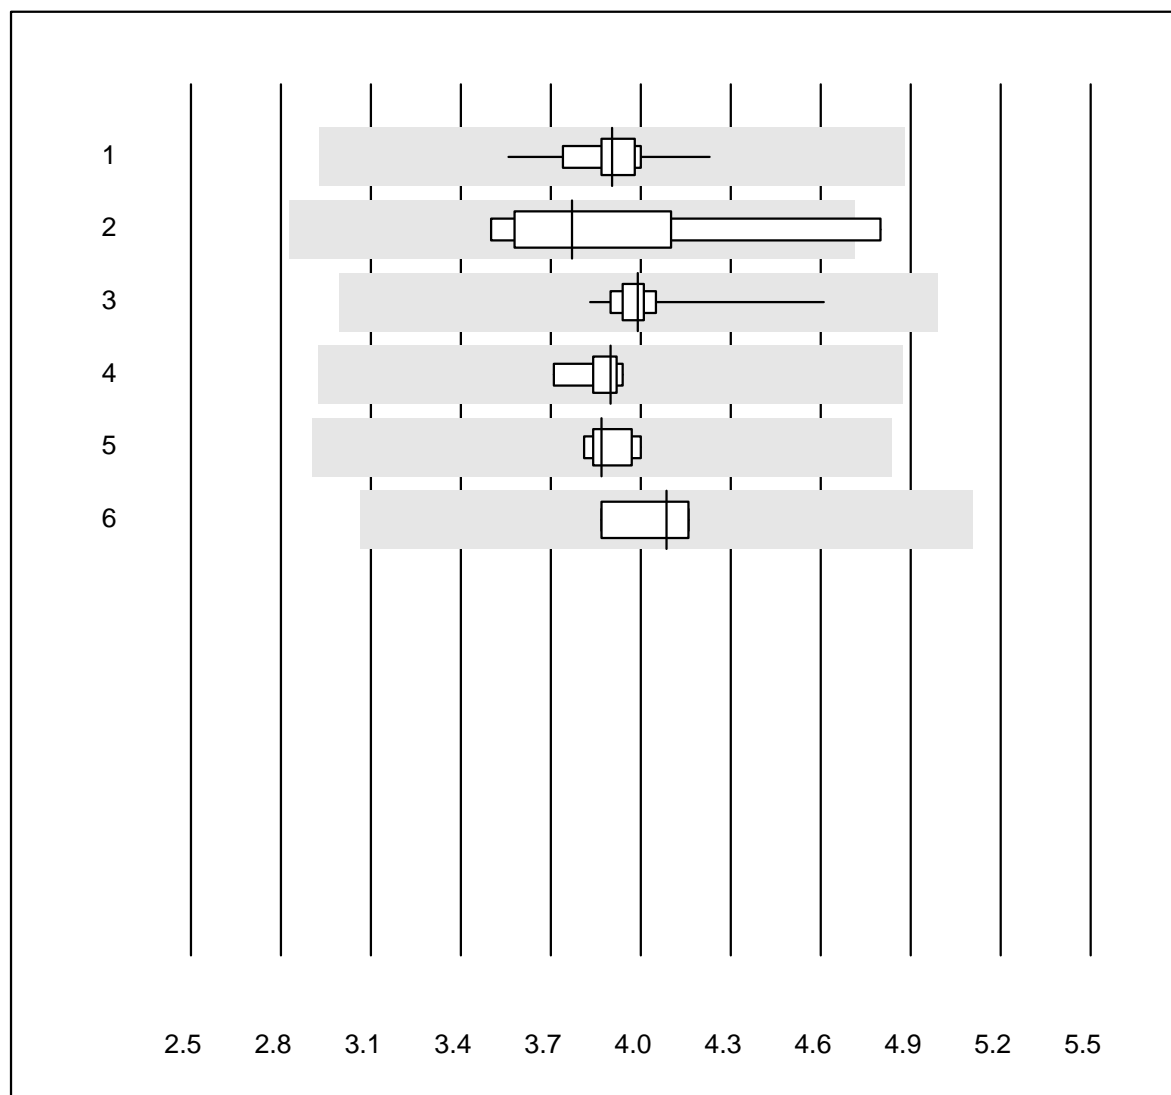


Tolérance QUALAB : 25 %

Erythrocytes (T/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Automate	28	96.4	0.0	3.6	3.90	3.4	e
2	Microscopie	7	85.7	14.3	0.0	3.77	11.3	e*
3	Sysmex X	39	100.0	0.0	0.0	3.99	2.9	e
4	Advia 120	9	100.0	0.0	0.0	3.90	1.9	e
5	ABX Pentra	9	100.0	0.0	0.0	3.87	1.9	e
6	MS4	4	75.0	0.0	25.0	4.09	3.6	e

Erythrocytes

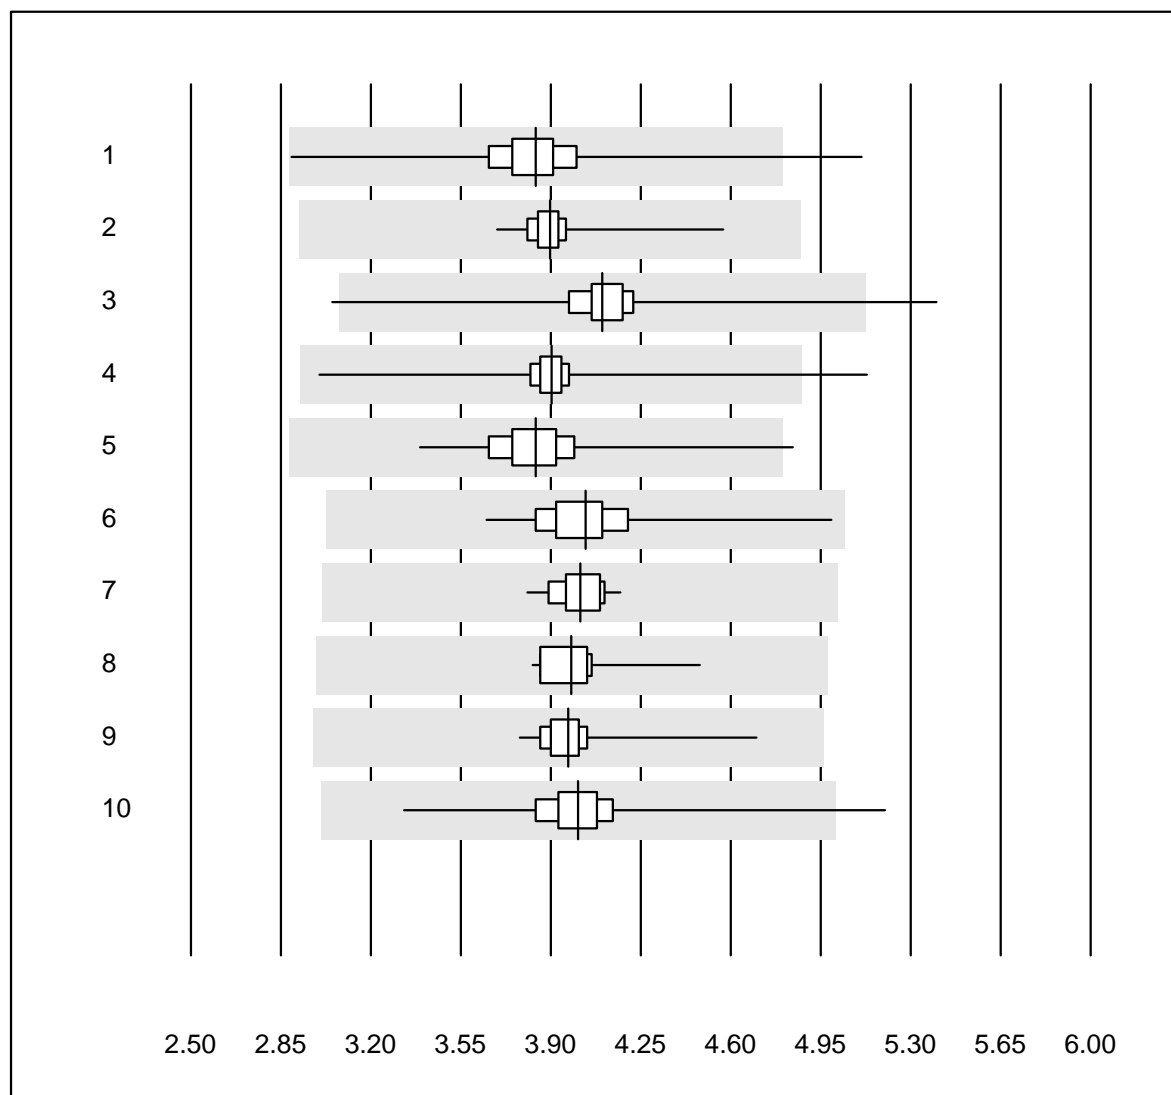


Tolérance QUALAB : 25 %

Erythrocytes (T/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Micros 60	271	98.2	0.7	1.1	3.84	5.4	e
2	Sysmex KX21	326	99.4	0.0	0.6	3.90	2.2	e
3	Sysmex PochH - 100i	195	98.5	1.0	0.5	4.10	4.1	e
4	Sysmex XP 300	406	98.8	0.5	0.7	3.90	3.2	e
5	Mythic	270	98.1	0.4	1.5	3.84	4.0	e
6	Swelab	50	100.0	0.0	0.0	4.04	4.7	e
7	Abacus Junior	11	100.0	0.0	0.0	4.01	2.5	e
8	Medonic	11	100.0	0.0	0.0	3.98	4.6	e
9	Nihon Kohden Celltac	68	98.5	0.0	1.5	3.97	2.9	e
10	Samsung HC10	45	97.8	2.2	0.0	4.01	5.9	e

Leucocytes

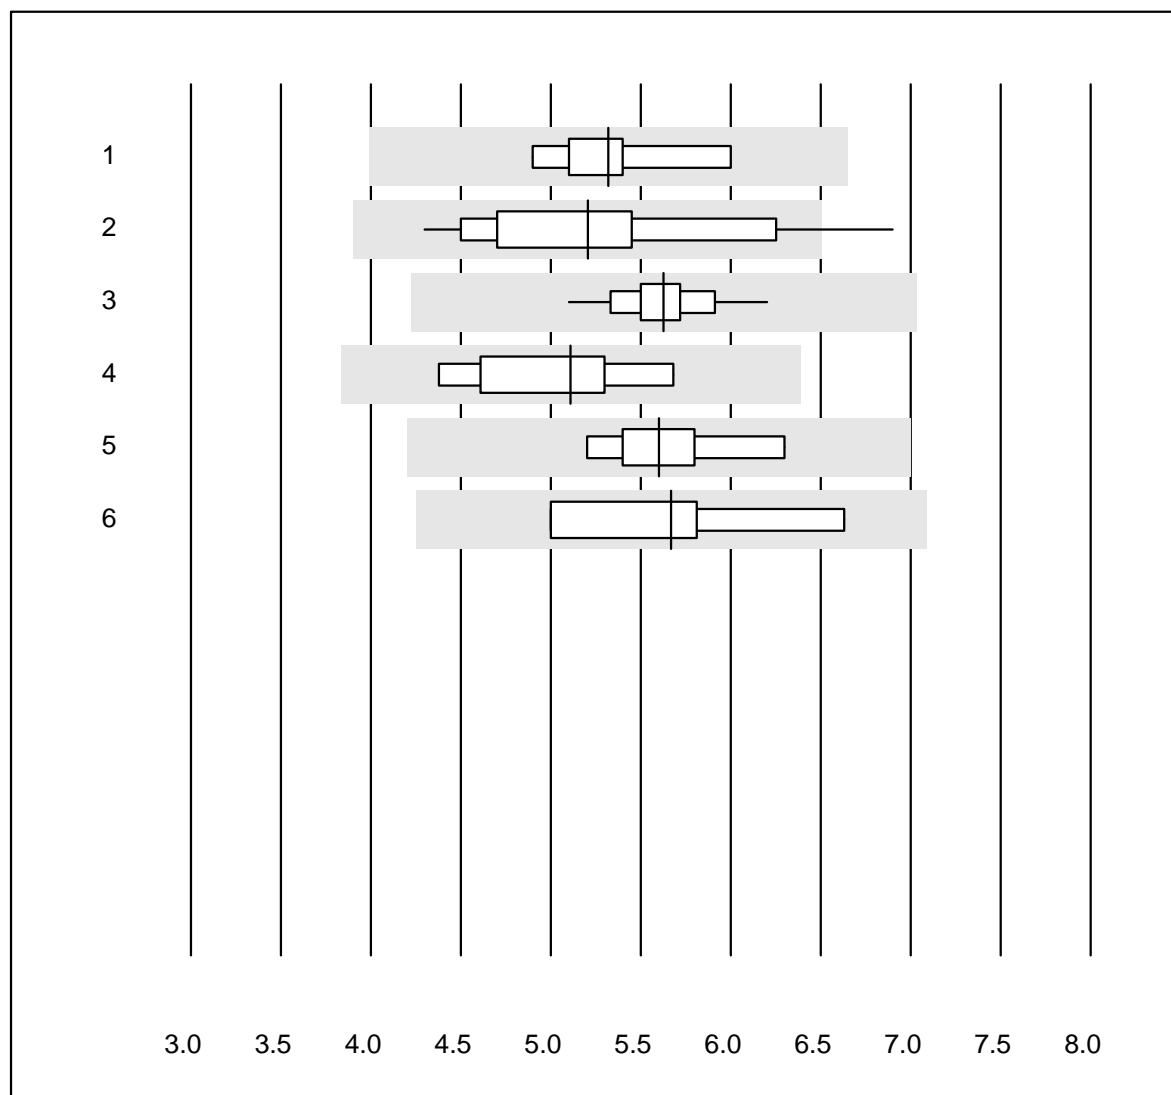


Tolérance QUALAB : 25 %

Leucocytes (G/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Automate	26	100.0	0.0	0.0	5.32	6.6	e
2	Microscopie	36	94.4	5.6	0.0	5.20	12.9	e
3	Sysmex X	39	100.0	0.0	0.0	5.63	4.0	e
4	Advia 120 (Perox)	9	88.9	0.0	11.1	5.11	8.8	e
5	ABX Pentra	9	100.0	0.0	0.0	5.60	5.8	e
6	MS4	4	100.0	0.0	0.0	5.67	11.8	e*

Leucocytes

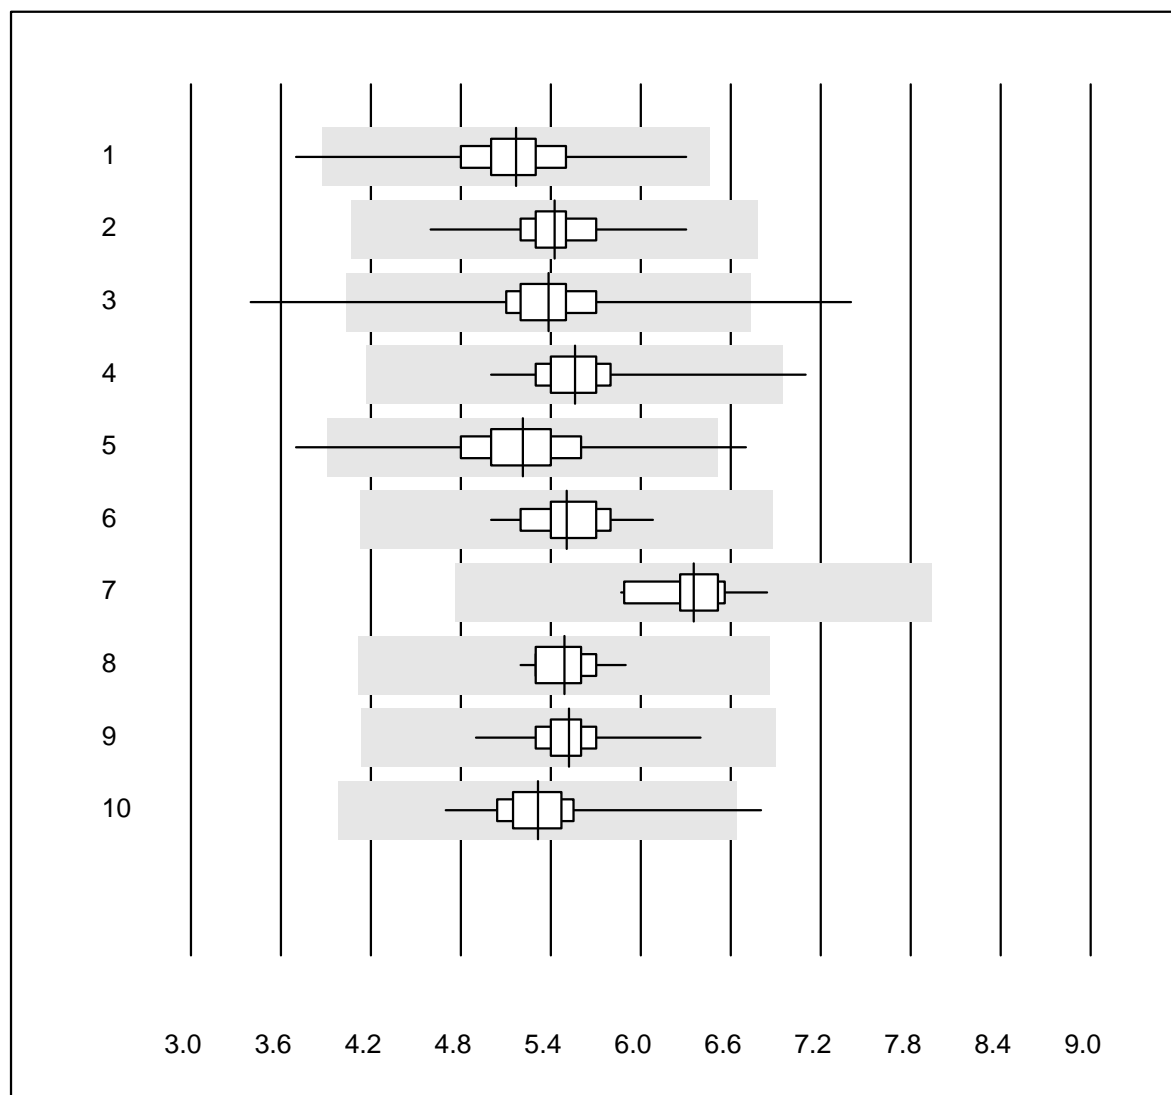


Tolérance QUALAB : 25 %

Leucocytes (G/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Micros 60	271	99.2	0.4	0.4	5.17	5.3	e
2	Sysmex KX21	325	100.0	0.0	0.0	5.42	3.7	e
3	Sysmex PochH - 100i	194	99.0	1.0	0.0	5.39	5.9	e
4	Sysmex XP 300	406	99.6	0.2	0.2	5.56	3.7	e
5	Mythic	269	98.9	1.1	0.0	5.21	6.9	e
6	Swelab	50	100.0	0.0	0.0	5.50	4.3	e
7	Abacus Junior	11	100.0	0.0	0.0	6.35	4.4	e
8	Medonic	11	100.0	0.0	0.0	5.49	3.7	e
9	Nihon Kohden Celltac	68	100.0	0.0	0.0	5.52	4.1	e
10	Samsung HC10	45	95.6	2.2	2.2	5.31	5.7	e

Thrombocytes

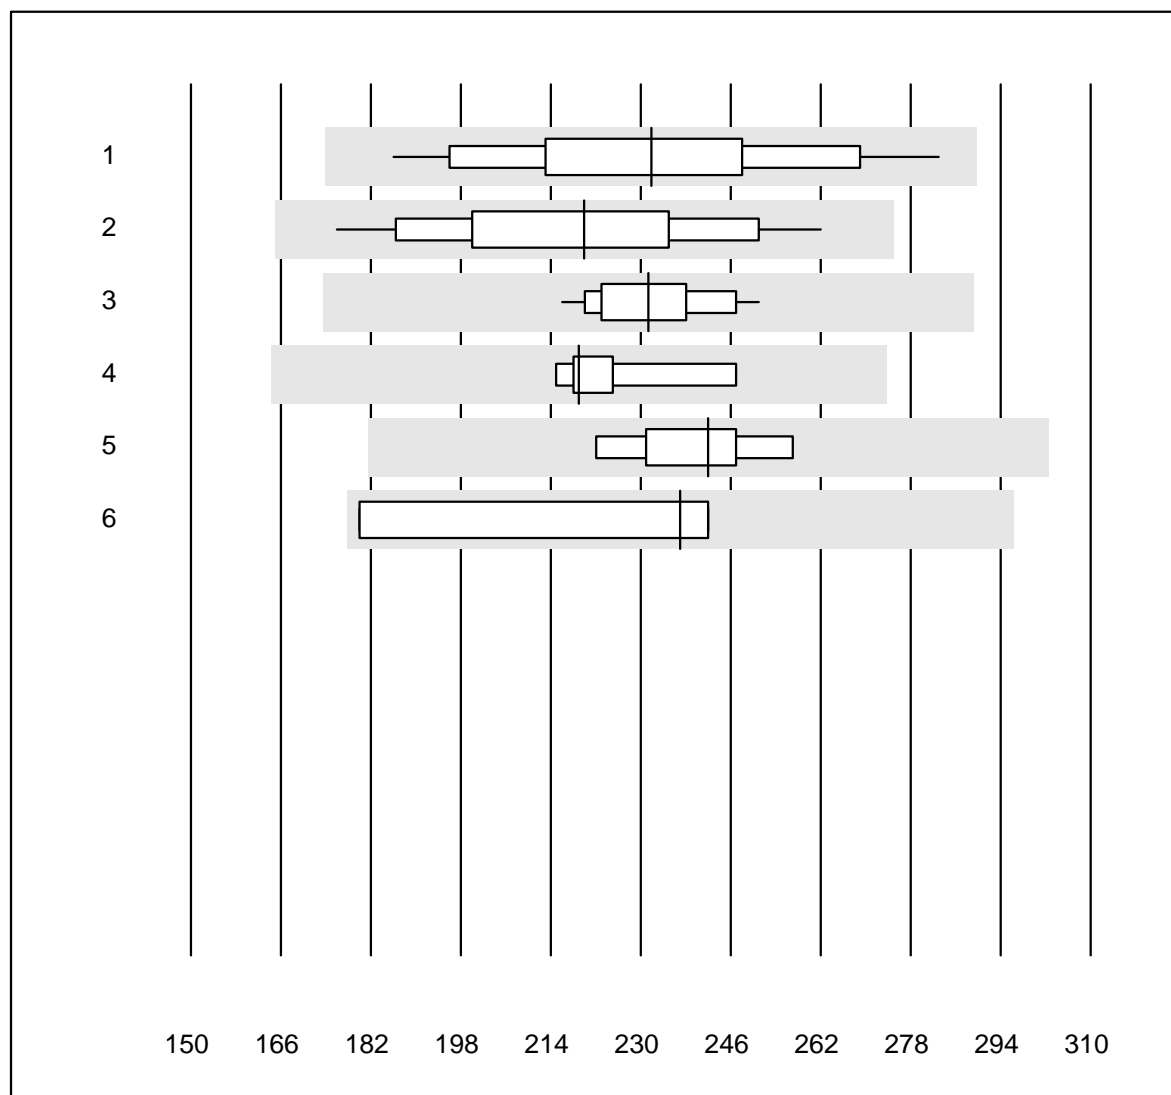


Tolérance QUALAB : 25 %

Thrombocytes (G/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Automate	24	100.0	0.0	0.0	231.9	11.1	e
2	Microscopie	24	95.8	0.0	4.2	220.0	11.2	e
3	Sysmex X	39	100.0	0.0	0.0	231.3	4.3	e
4	Advia 120	9	100.0	0.0	0.0	219.0	5.3	e
5	ABX Pentra	9	100.0	0.0	0.0	242.0	4.9	e
6	MS4	4	75.0	0.0	25.0	237.0	15.3	e*

Thrombocytes

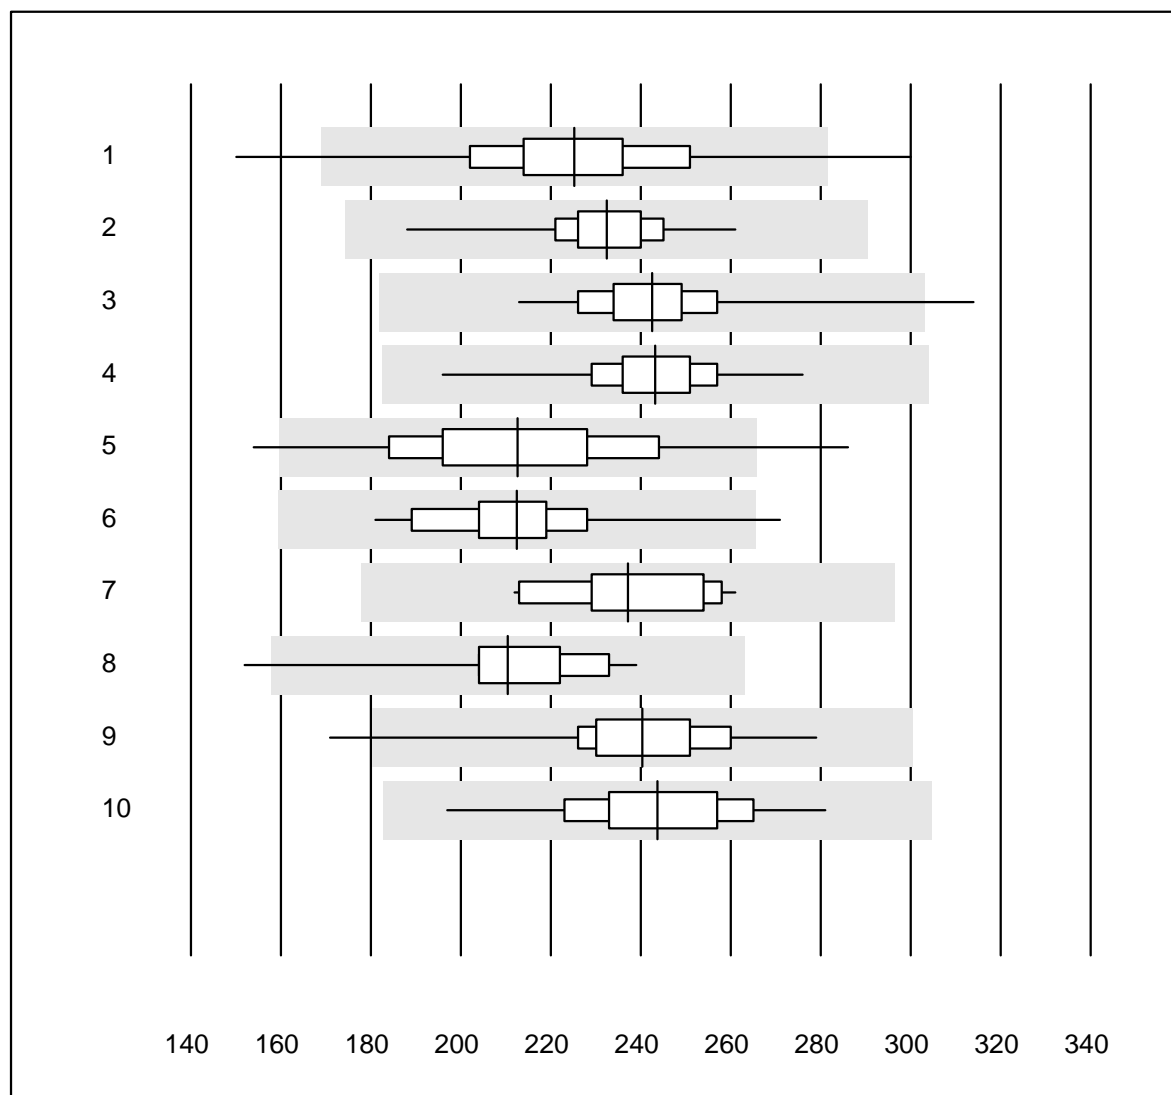


Tolérance QUALAB : 25 %

Thrombocytes (G/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Micros 60	271	96.7	2.6	0.7	225.2	9.7	e
2	Sysmex KX21	326	100.0	0.0	0.0	232.4	4.5	e
3	Sysmex PochH - 100i	194	99.0	0.5	0.5	242.4	5.7	e
4	Sysmex XP 300	406	100.0	0.0	0.0	243.3	4.8	e
5	Mythic	270	96.3	2.2	1.5	212.6	11.1	e
6	Swelab	50	98.0	2.0	0.0	212.4	8.0	e
7	Abacus Junior	11	100.0	0.0	0.0	237.2	7.0	e
8	Medonic	11	90.9	9.1	0.0	210.5	10.6	e*
9	Nihon Kohden Celltac	68	97.1	2.9	0.0	240.4	7.4	e
10	Samsung HC10	45	100.0	0.0	0.0	243.6	7.2	e

Hémoglobine H2

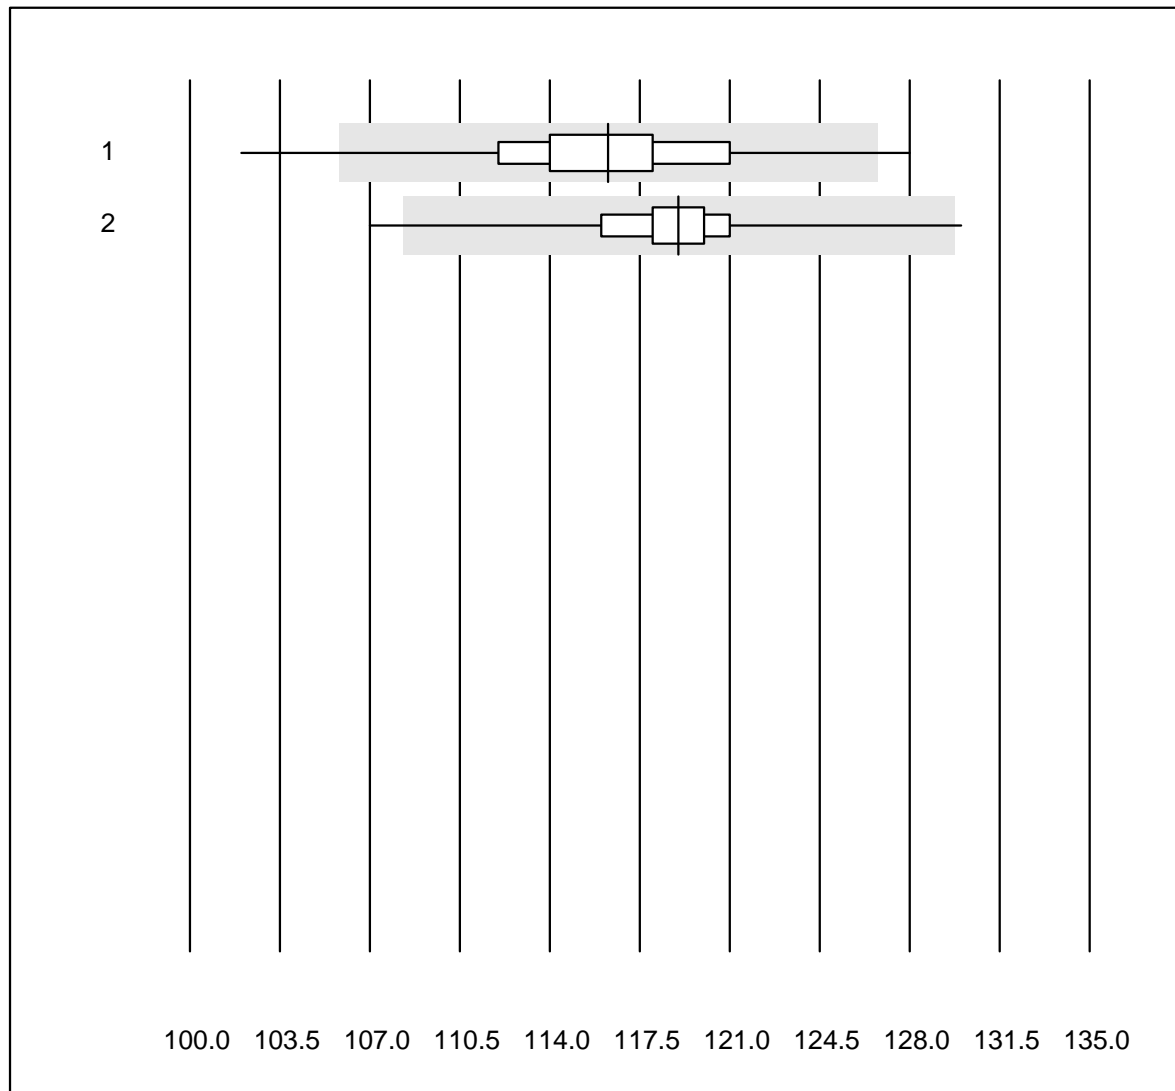


Tolérance QUALAB : 9 %

Hémoglobine H2 (g/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Abx Micros	250	96.4	2.8	0.8	116.3	3.2	e
2 Microsemi	576	98.5	0.3	1.2	119.0	1.9	e

Hématocrite H2

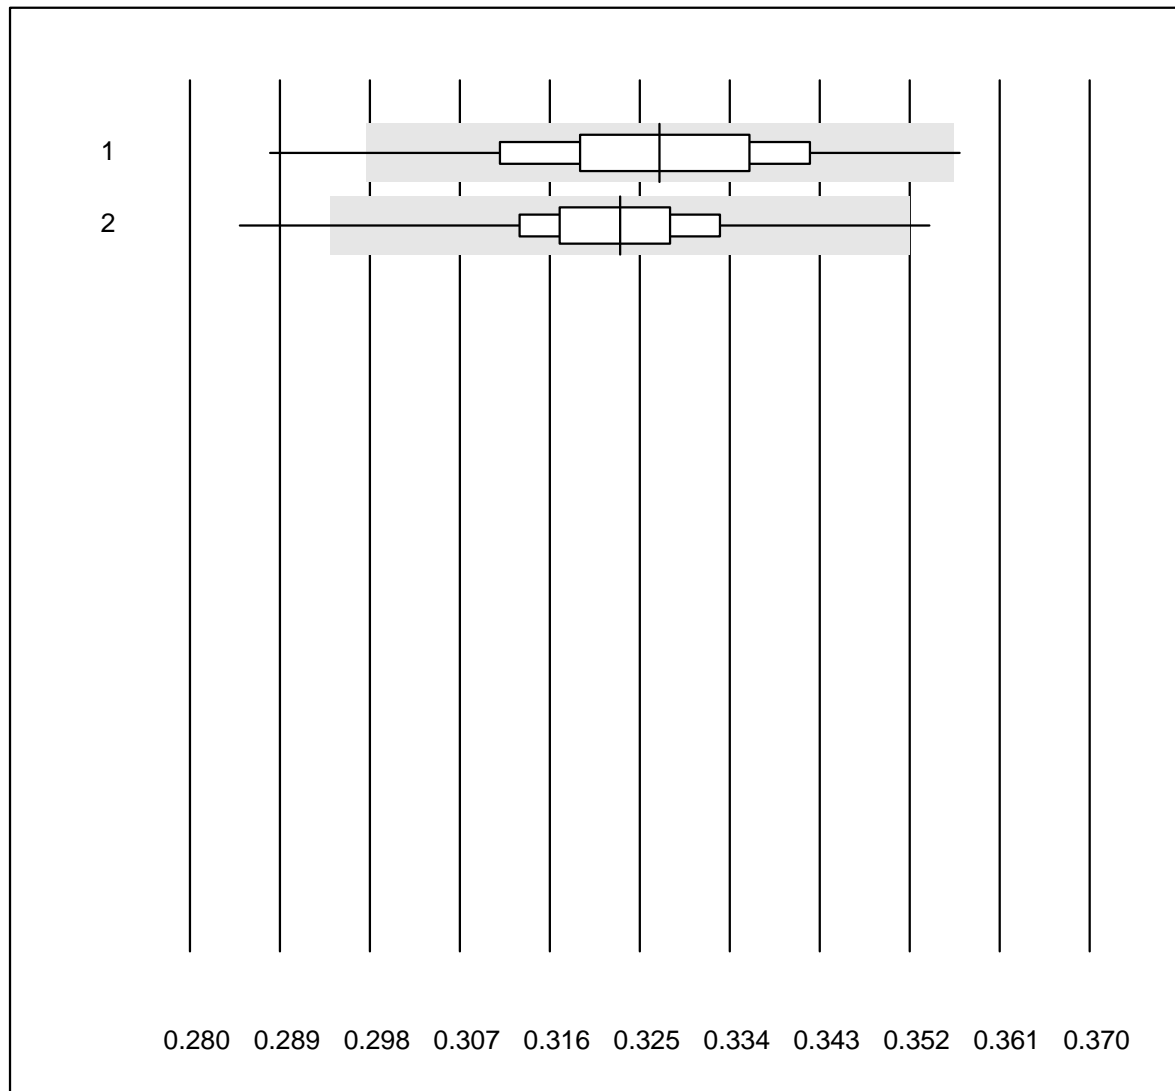


Tolérance QUALAB : 9 %

Hématocrite H2 (l/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Abx Micros	249	95.2	2.8	2.0	0.33	3.9	e
2 Microsemi	576	98.5	0.3	1.2	0.32	2.6	e

Leucocytes H2

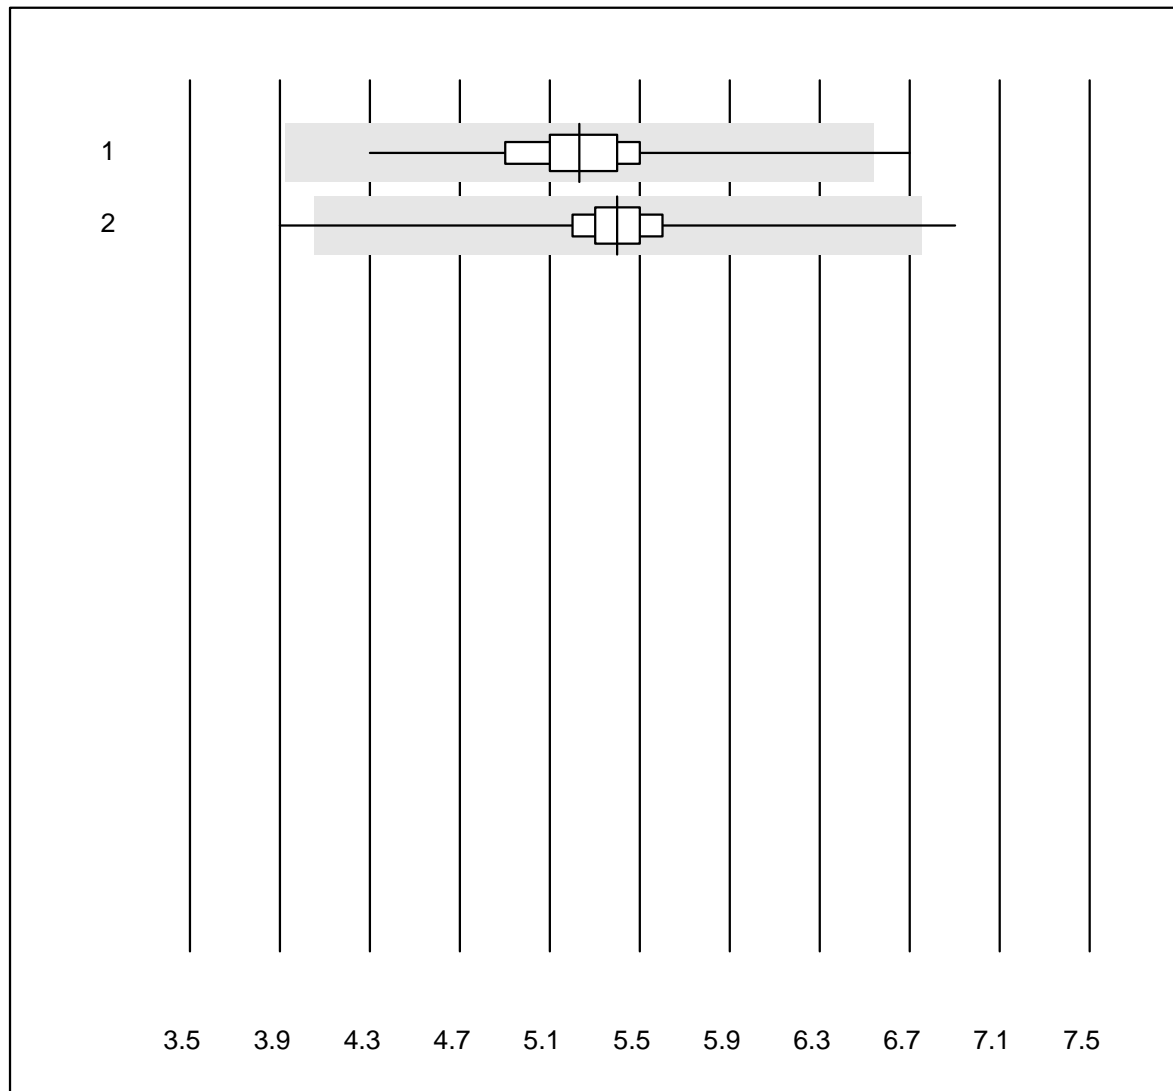


Tolérance QUALAB : 25 %

Leucocytes H2 (G/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Abx Micros	249	99.2	0.4	0.4	5.23	5.2	e
2	Microsemi	576	99.2	0.3	0.5	5.40	3.9	e

Thrombocytes H2

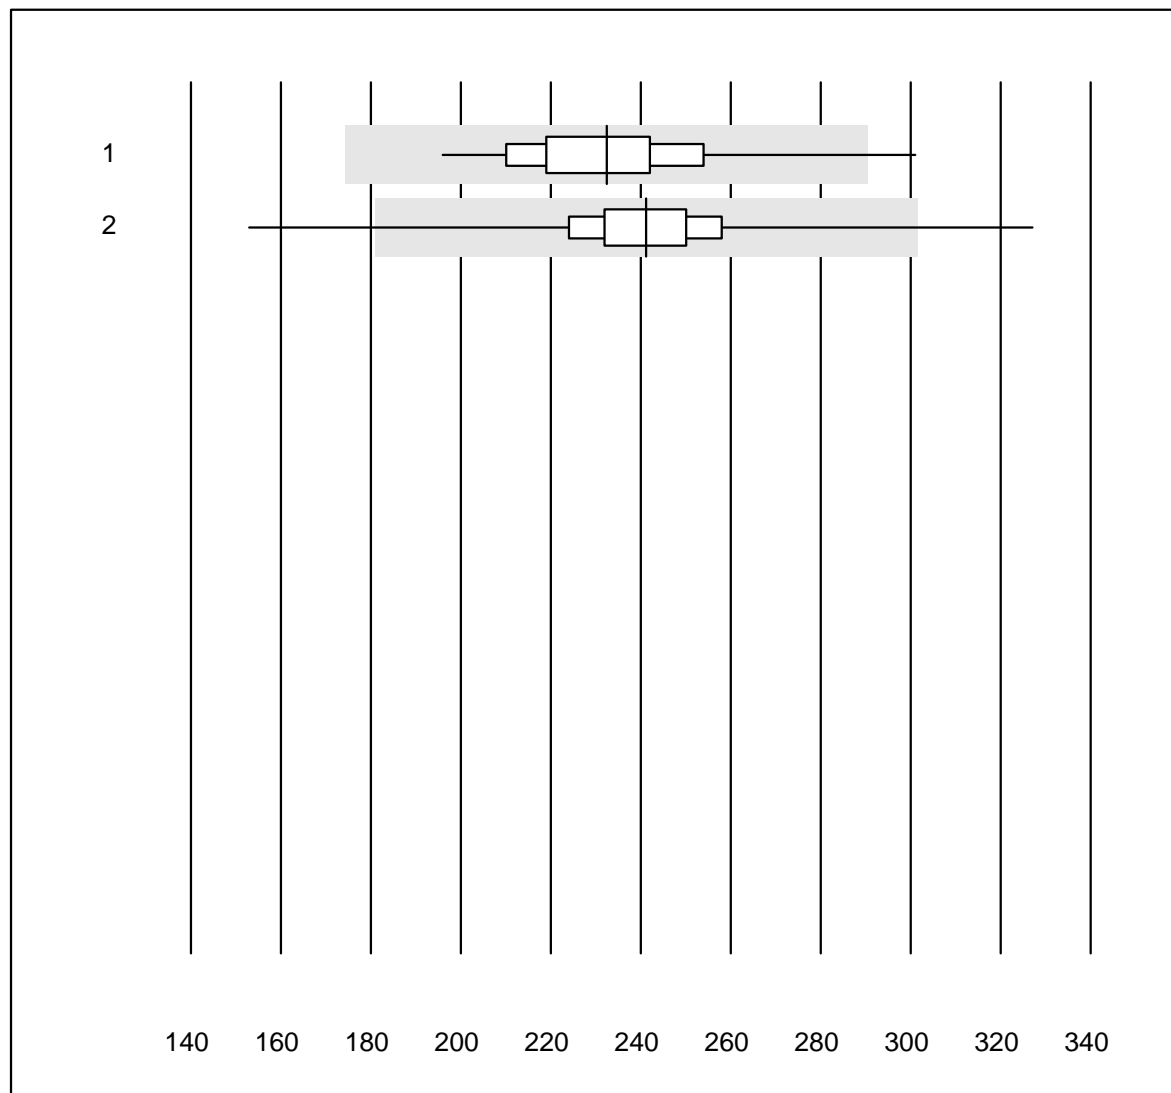


Tolérance QUALAB : 25 %

Thrombocytes H2 (G/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Abx Micros	249	97.2	0.8	2.0	232.4	7.7	e
2	Microsemi	576	99.2	0.3	0.5	241.2	6.1	e

Erythrocytes H2

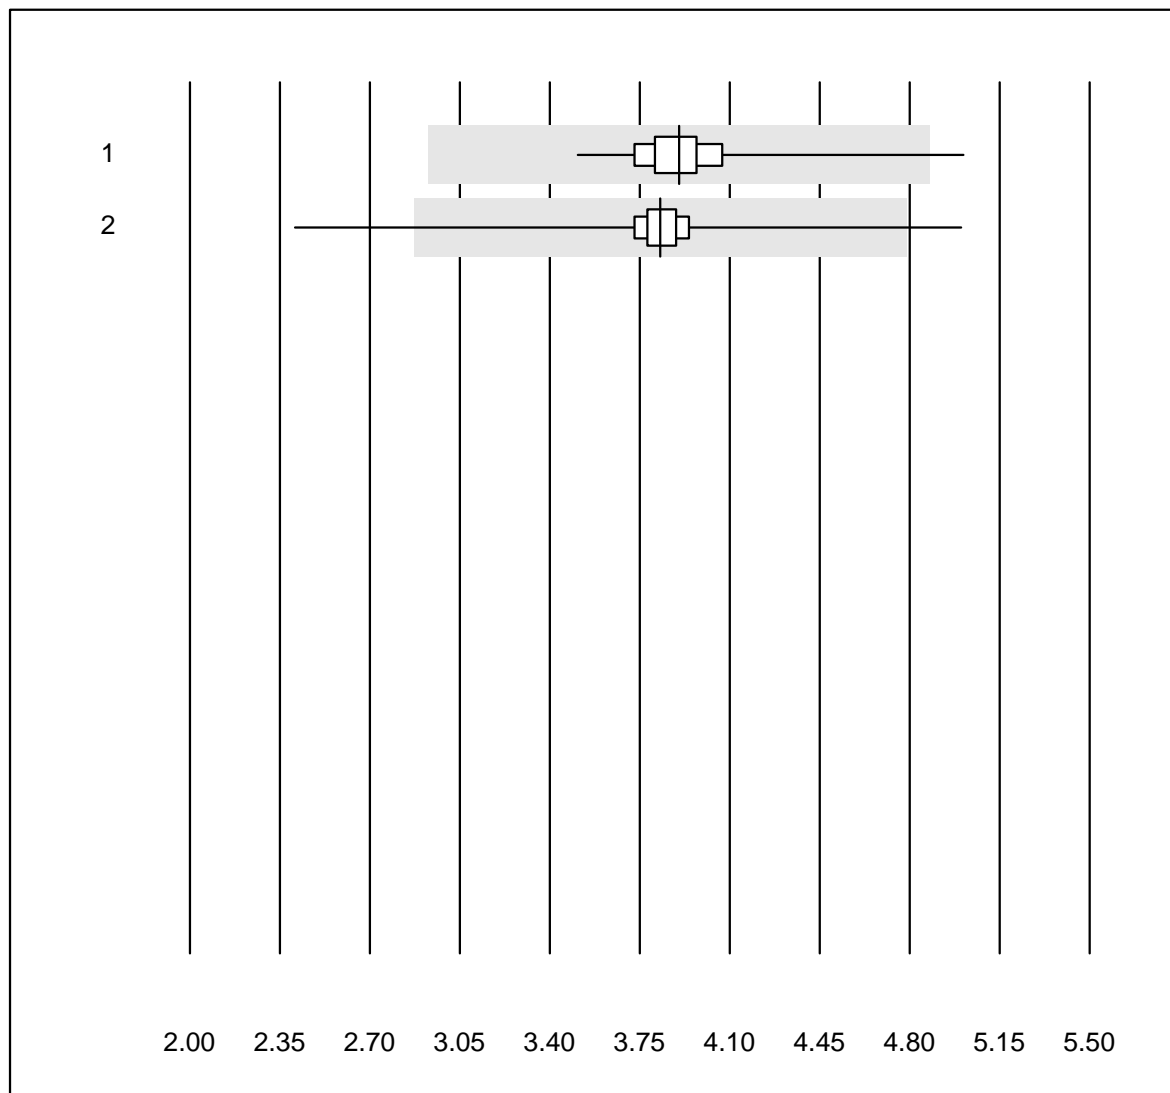


Tolérance QUALAB : 25 %

Erythrocytes H2 (T/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Abx Micros	248	98.4	0.4	1.2	3.90	4.1	e
2	Microsemi	576	98.4	0.7	0.9	3.83	3.7	e

CRP H2

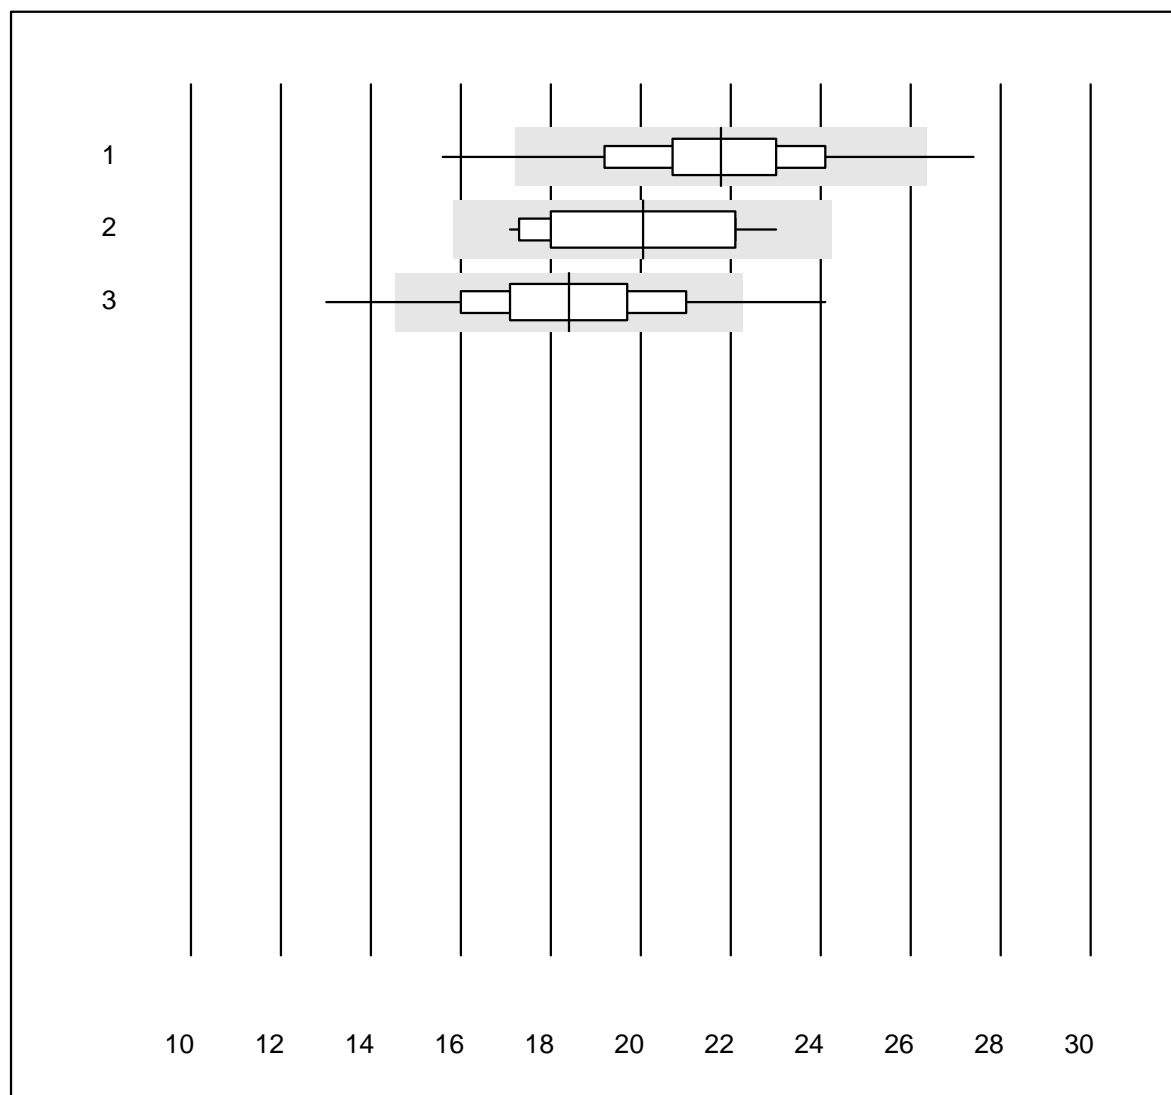


Tolérance QUALAB : 21 %

CRP H2 (mg/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Microsemi	571	97.4	1.9	0.7	21.8	8.7	e
2	Abx Micros	24	95.8	0.0	4.2	20.0	10.1	e
3	ABX Micros CRP200	219	94.1	4.1	1.8	18.4	10.7	e

Hémoglobine BG

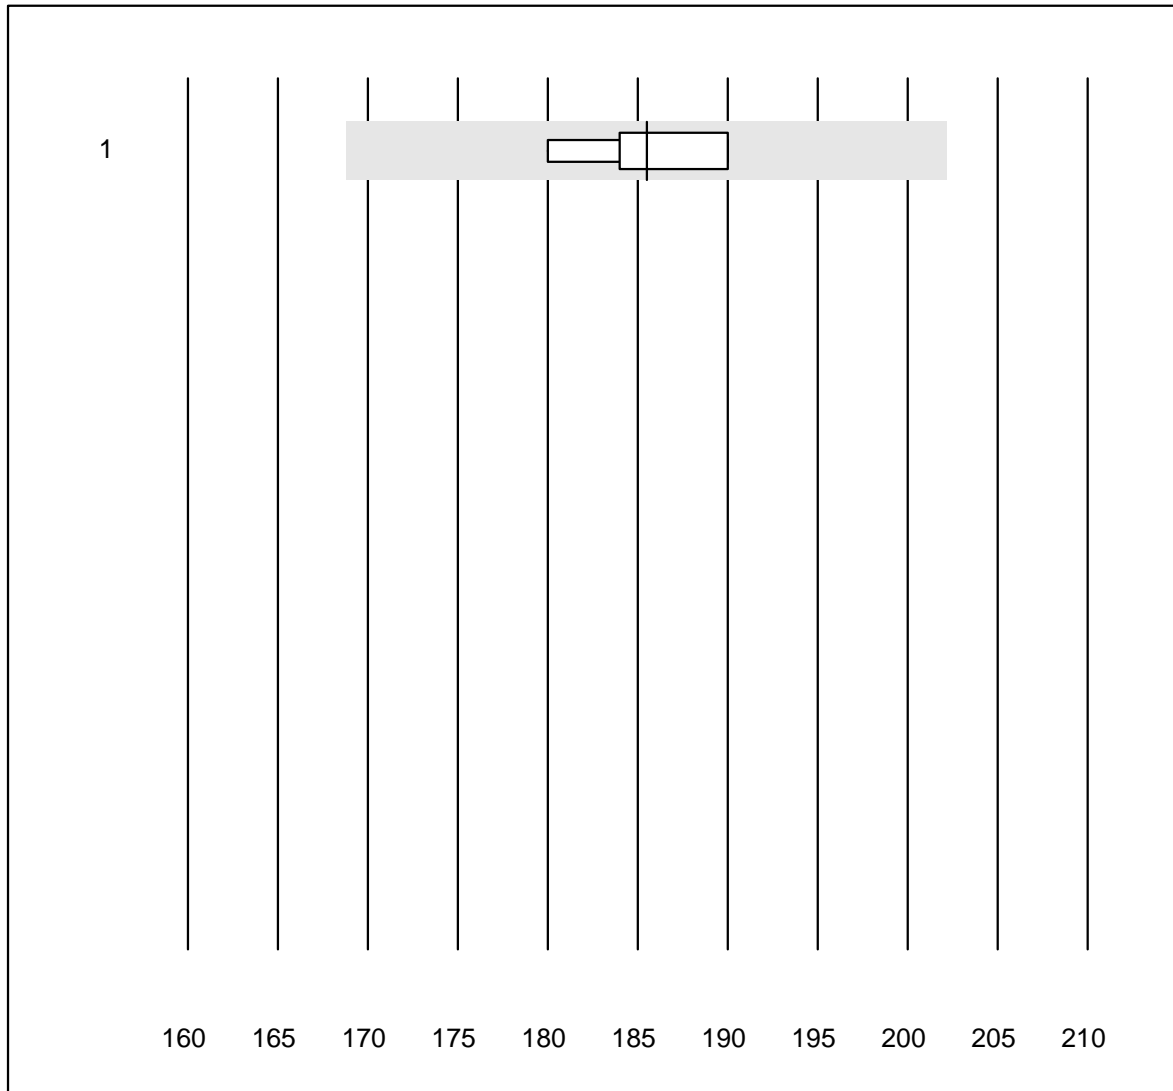


Tolérance QUALAB : 9 %

Hémoglobine BG (g/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 iStat	6	100.0	0.0	0.0	185.5	2.1	e

Hématocrite

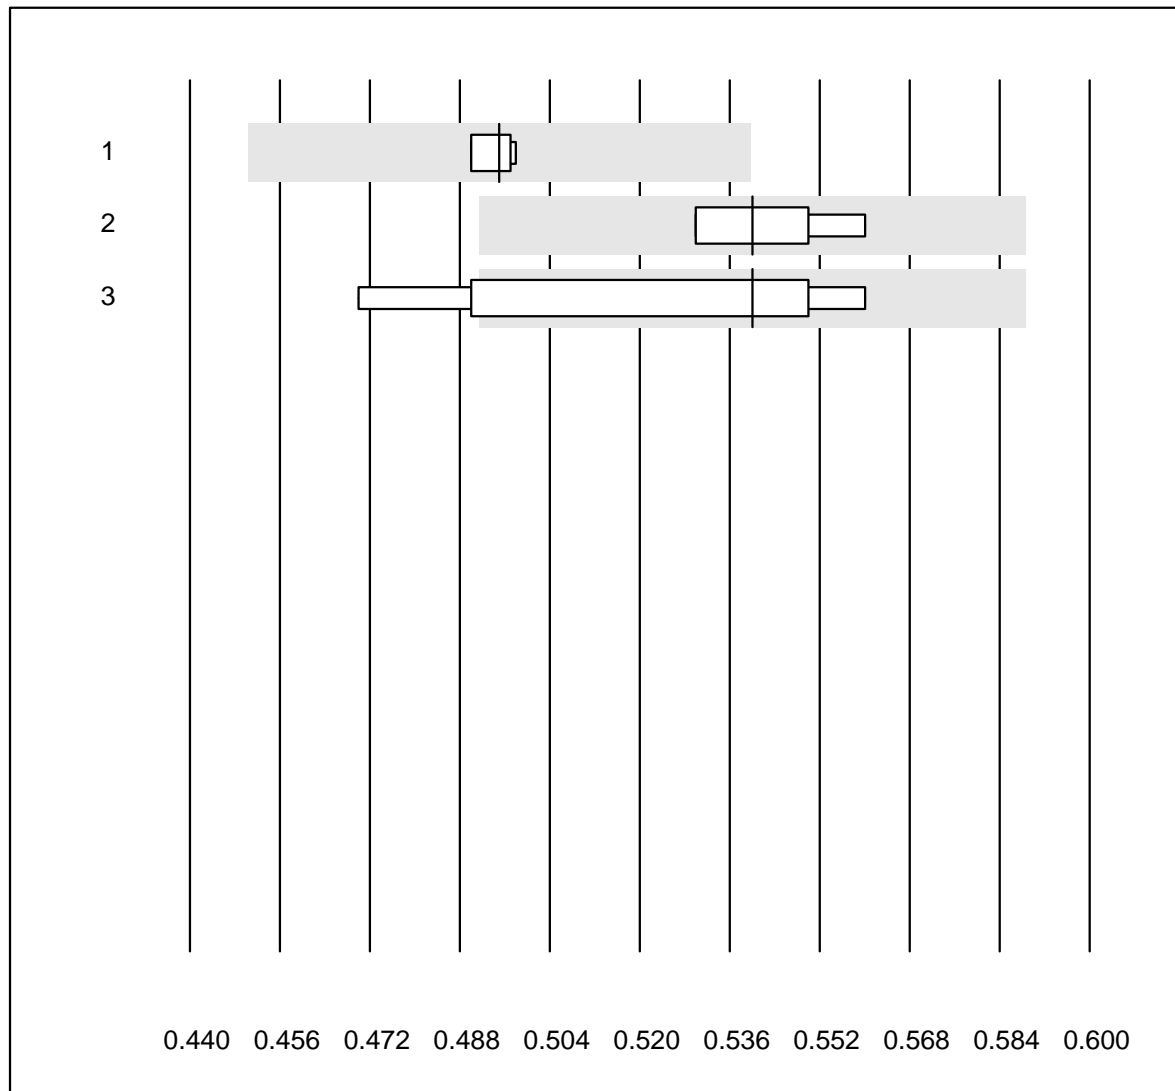


Tolérance QUALAB : 9 %

Hématocrite (l/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	0.50	0.7	e
2 iStat	8	100.0	0.0	0.0	0.54	2.2	e
3 EPOC	5	60.0	40.0	0.0	0.54	7.6	e*

Hémoglobine

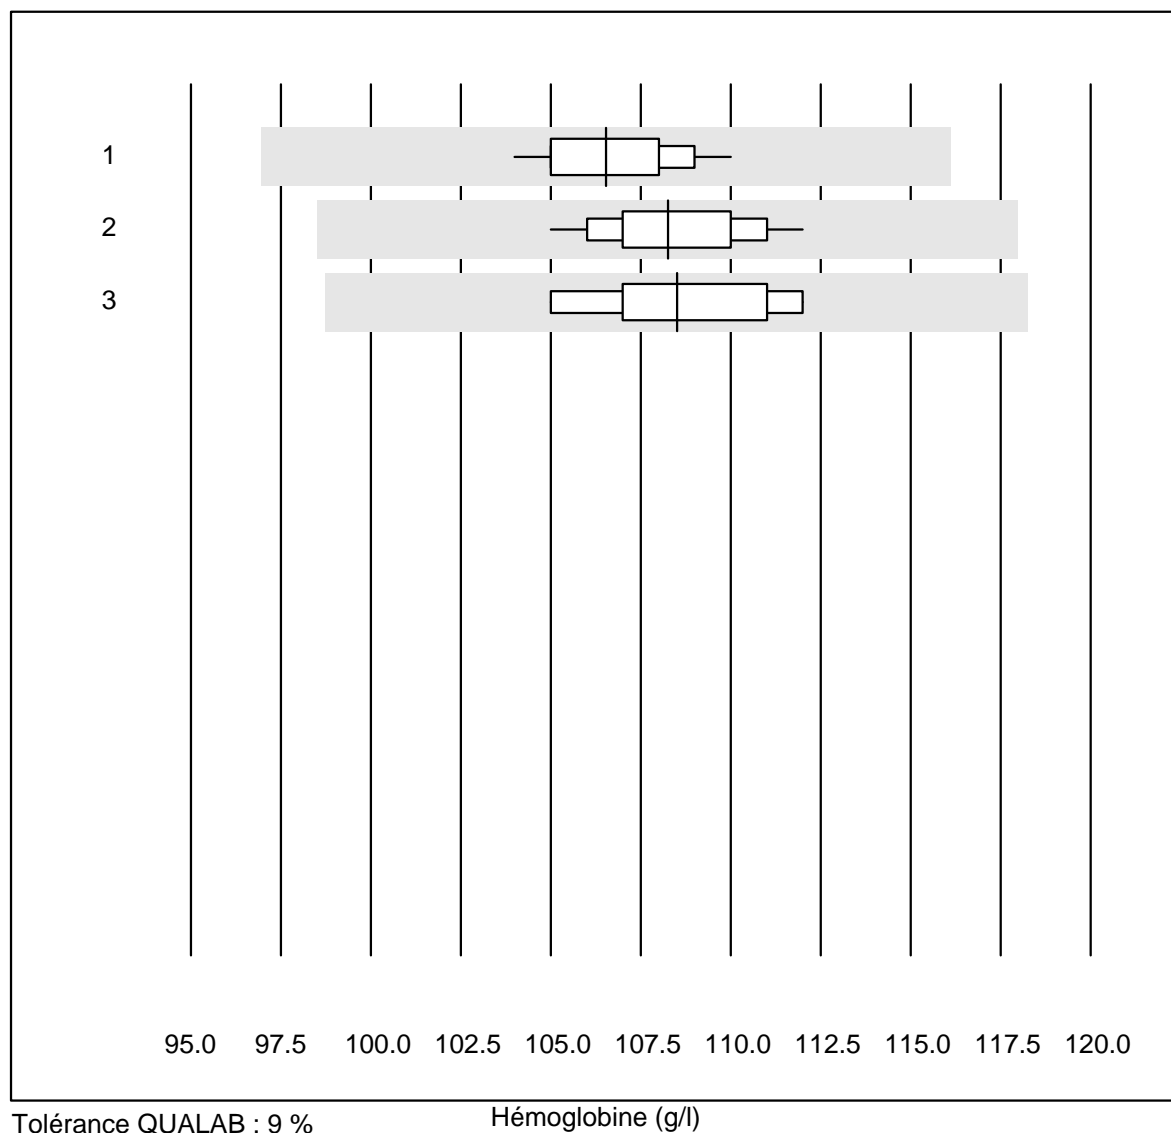

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Sysmex	43	100.0	0.0	0.0	106.5	1.4	e
2 Advia	12	100.0	0.0	0.0	108.3	1.9	e
3 ABX Pentra	9	100.0	0.0	0.0	108.5	2.3	e

Hématocrite

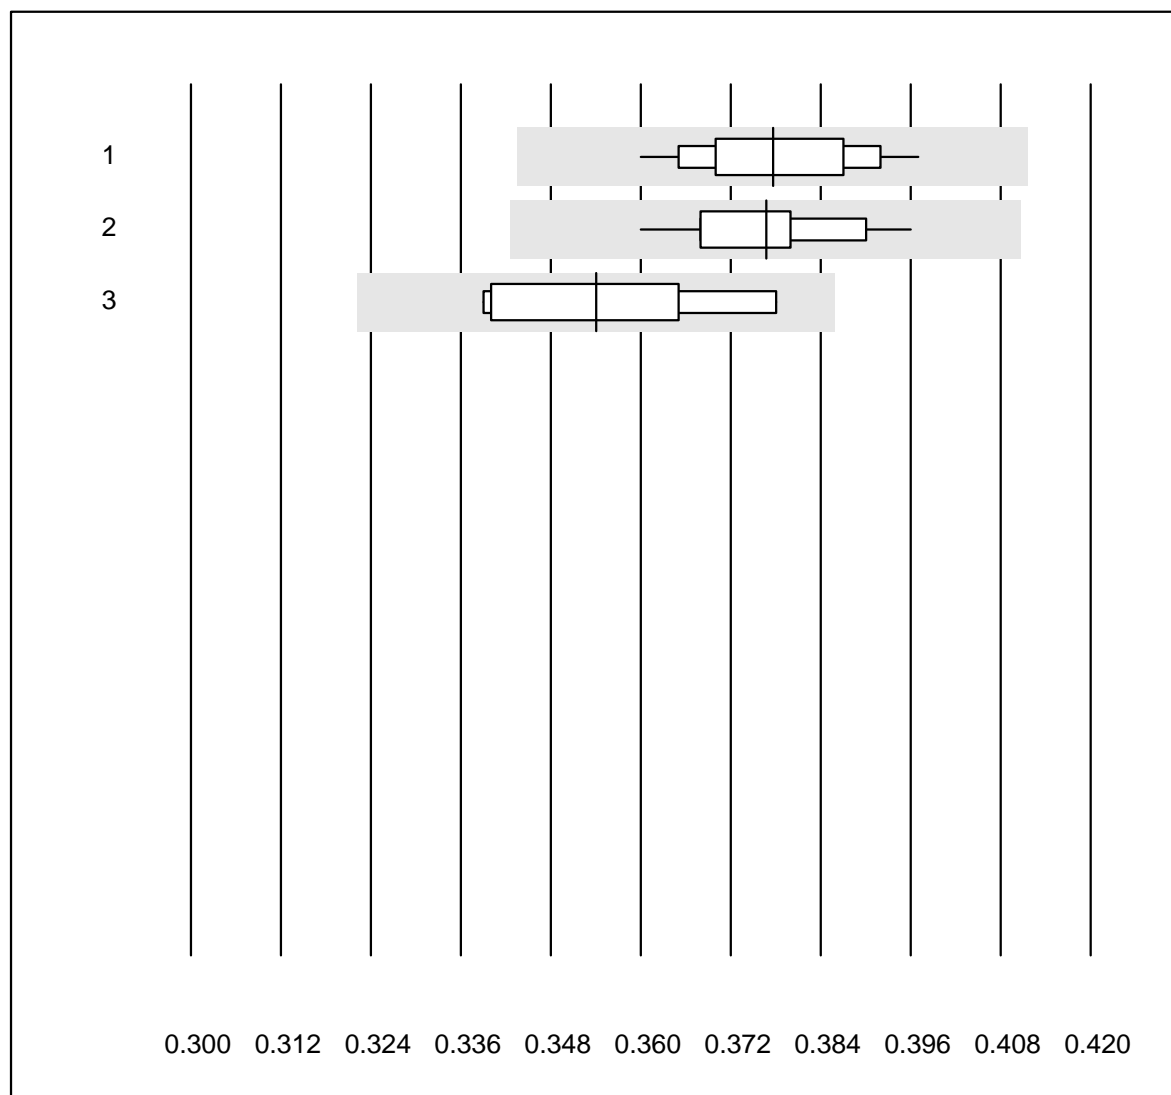


Tolérance QUALAB : 9 %

Hématocrite (l/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Sysmex	43	97.7	0.0	2.3	0.38	2.9	e
2 Advia	12	100.0	0.0	0.0	0.38	2.9	e
3 ABX Pentra	9	100.0	0.0	0.0	0.35	4.5	a

Erythrocytes

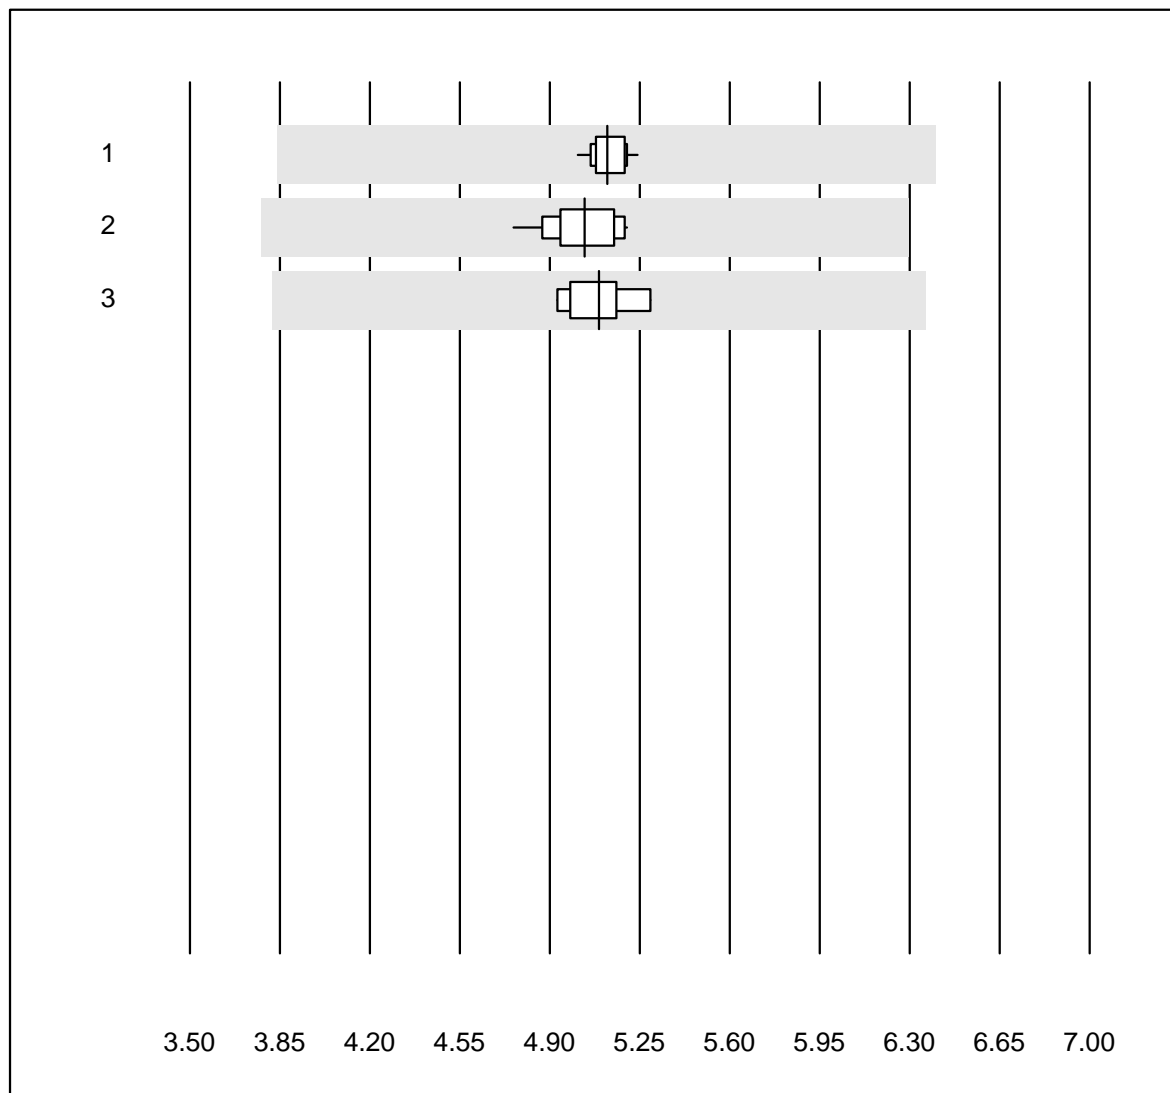


Tolérance QUALAB : 25 %

Erythrocytes (T/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Sysmex	43	100.0	0.0	0.0	5.12	1.1	e
2	Advia	12	100.0	0.0	0.0	5.04	2.7	e
3	ABX Pentra	9	100.0	0.0	0.0	5.09	2.3	e

Leucocytes

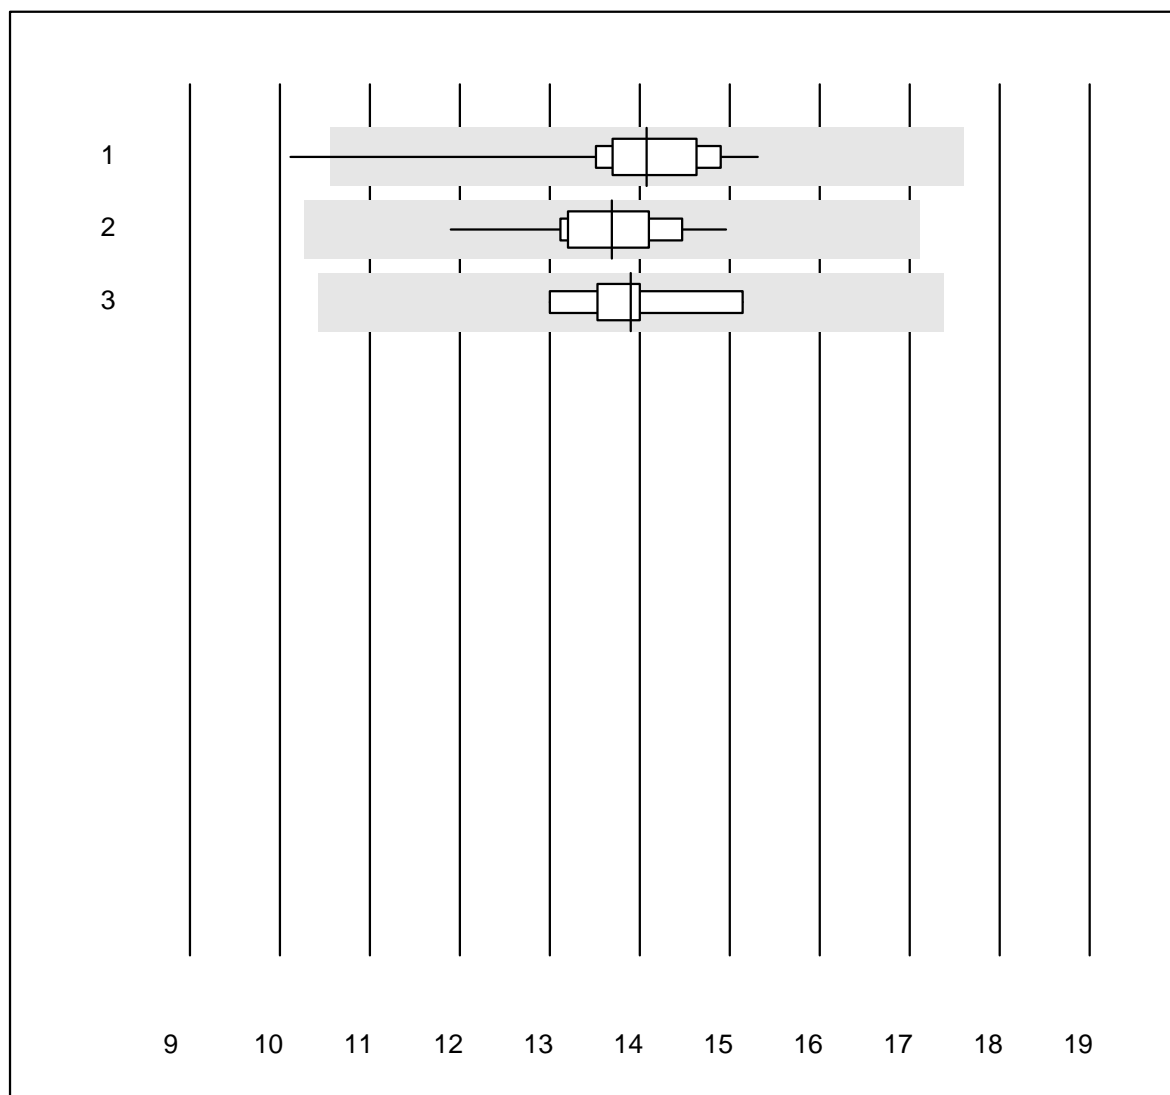


Tolérance QUALAB : 25 %

Leucocytes (G/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Sysmex	43	97.7	2.3	0.0	14.08	6.0	e
2	Advia	12	100.0	0.0	0.0	13.69	5.9	e
3	ABX Pentra	9	100.0	0.0	0.0	13.90	4.7	e

Thrombocytes

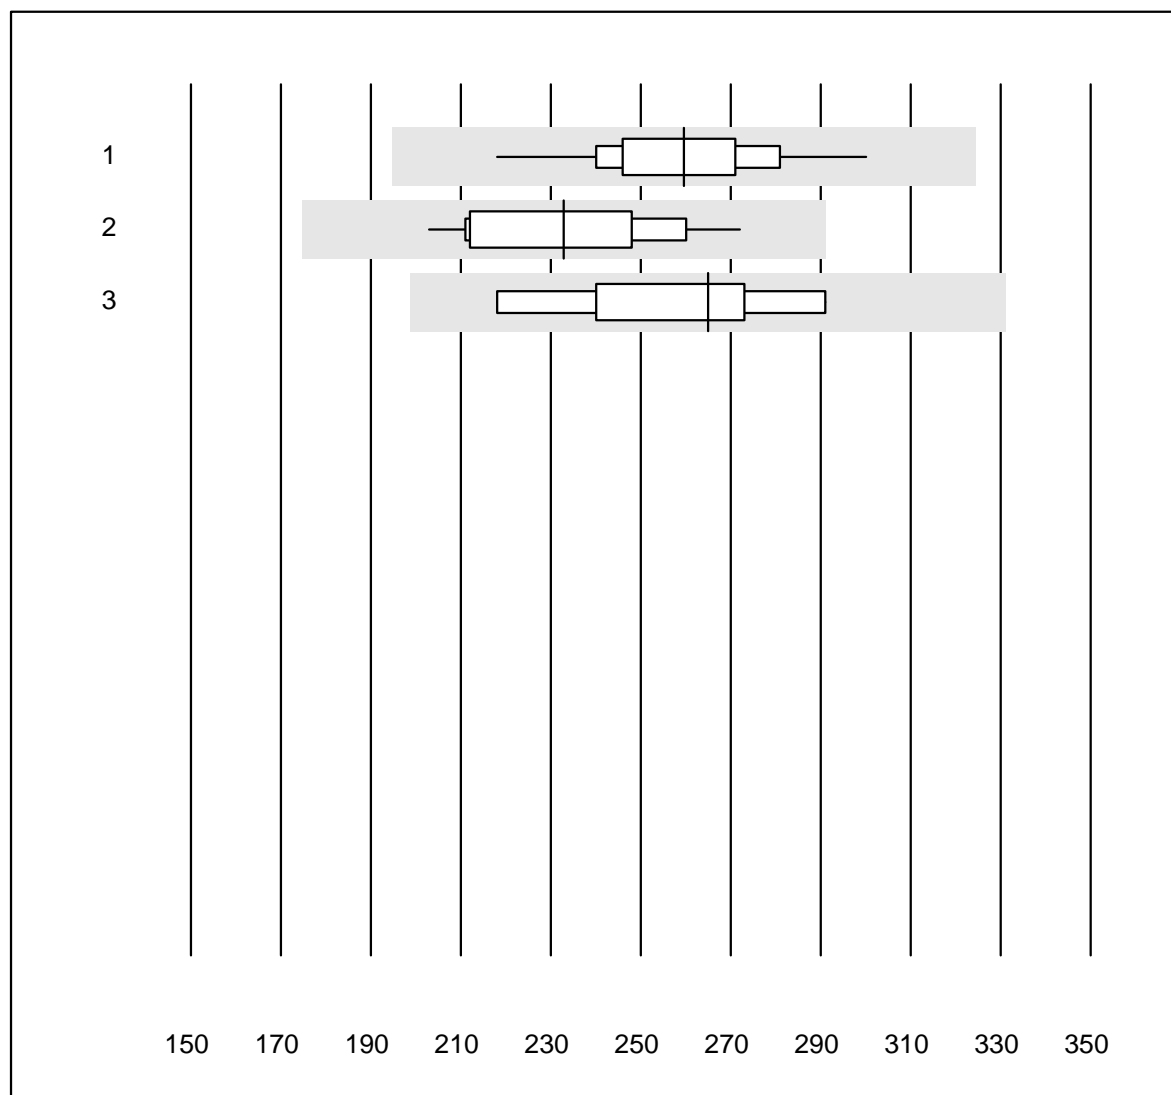


Tolérance QUALAB : 25 %

Thrombocytes (G/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Sysmex	43	100.0	0.0	0.0	259.6	6.6	e
2 Advia	12	100.0	0.0	0.0	232.9	9.7	e
3 ABX Pentra	9	100.0	0.0	0.0	265.0	9.3	e*

Neutrophiles

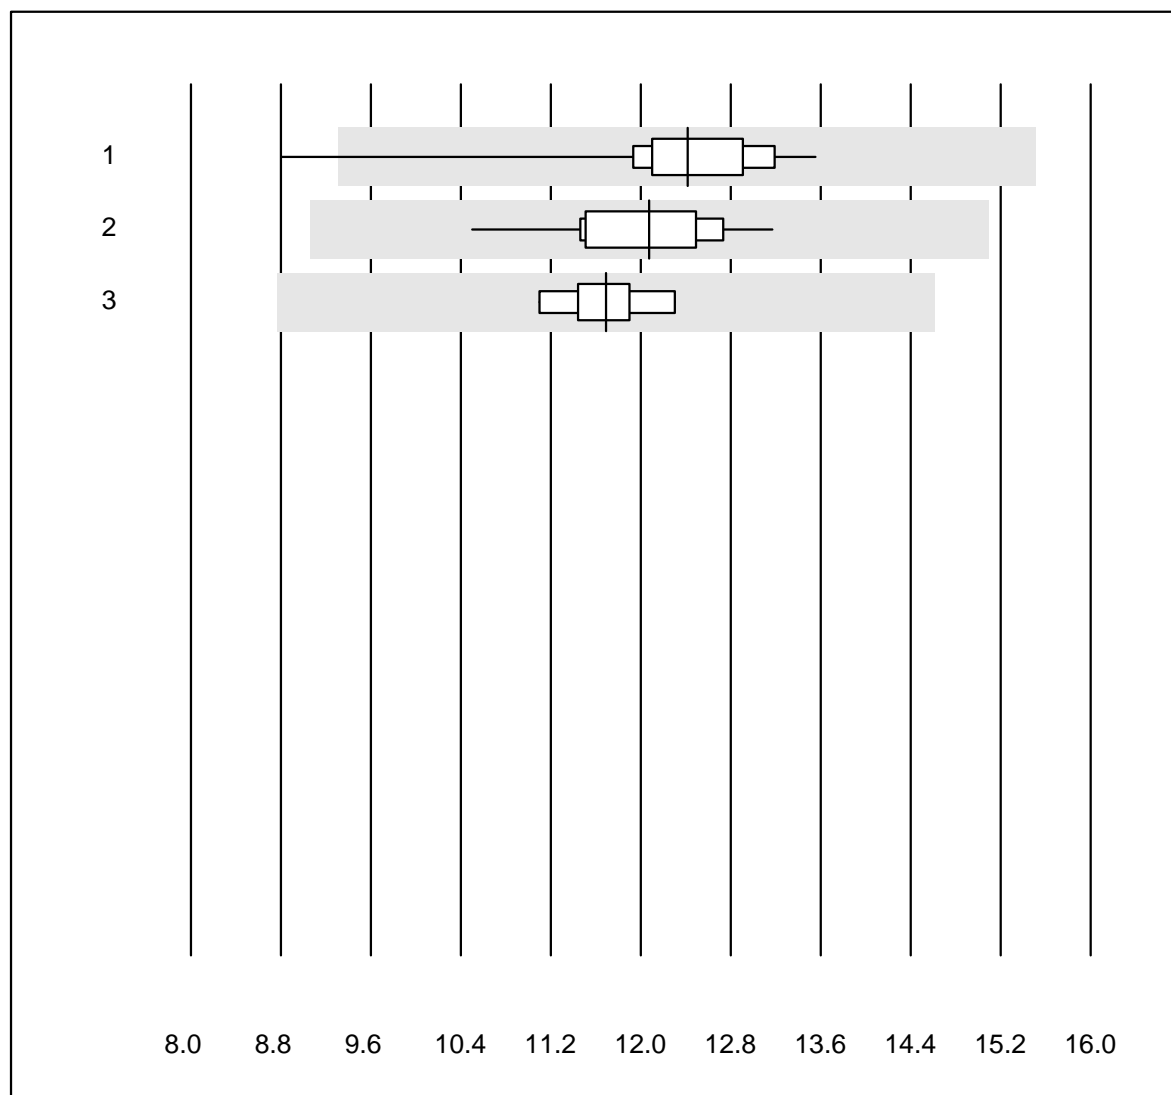


Tolérance MQ : 25 %

Neutrophiles (G/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Sysmex	43	97.7	2.3	0.0	12.41	6.2	e
2	Advia	12	100.0	0.0	0.0	12.07	5.9	e
3	ABX Pentra	9	100.0	0.0	0.0	11.69	3.5	e

Lymphocytes

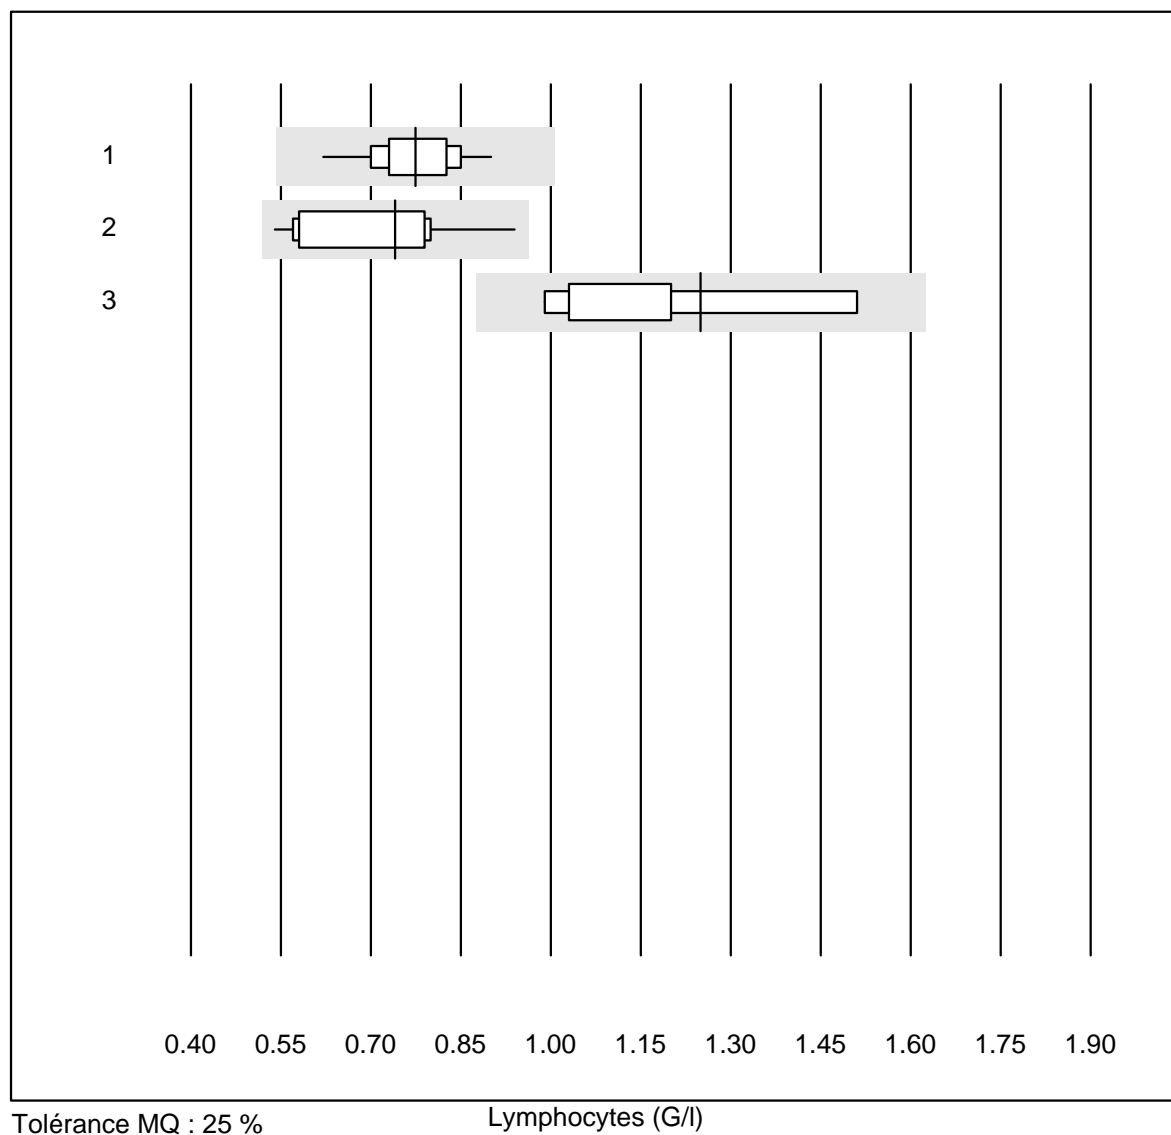

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Sysmex	43	100.0	0.0	0.0	0.77	8.3	a
2 Advia	12	91.7	0.0	8.3	0.74	18.4	a
3 ABX Pentra	9	88.9	0.0	11.1	1.25	13.6	a

Monocytes

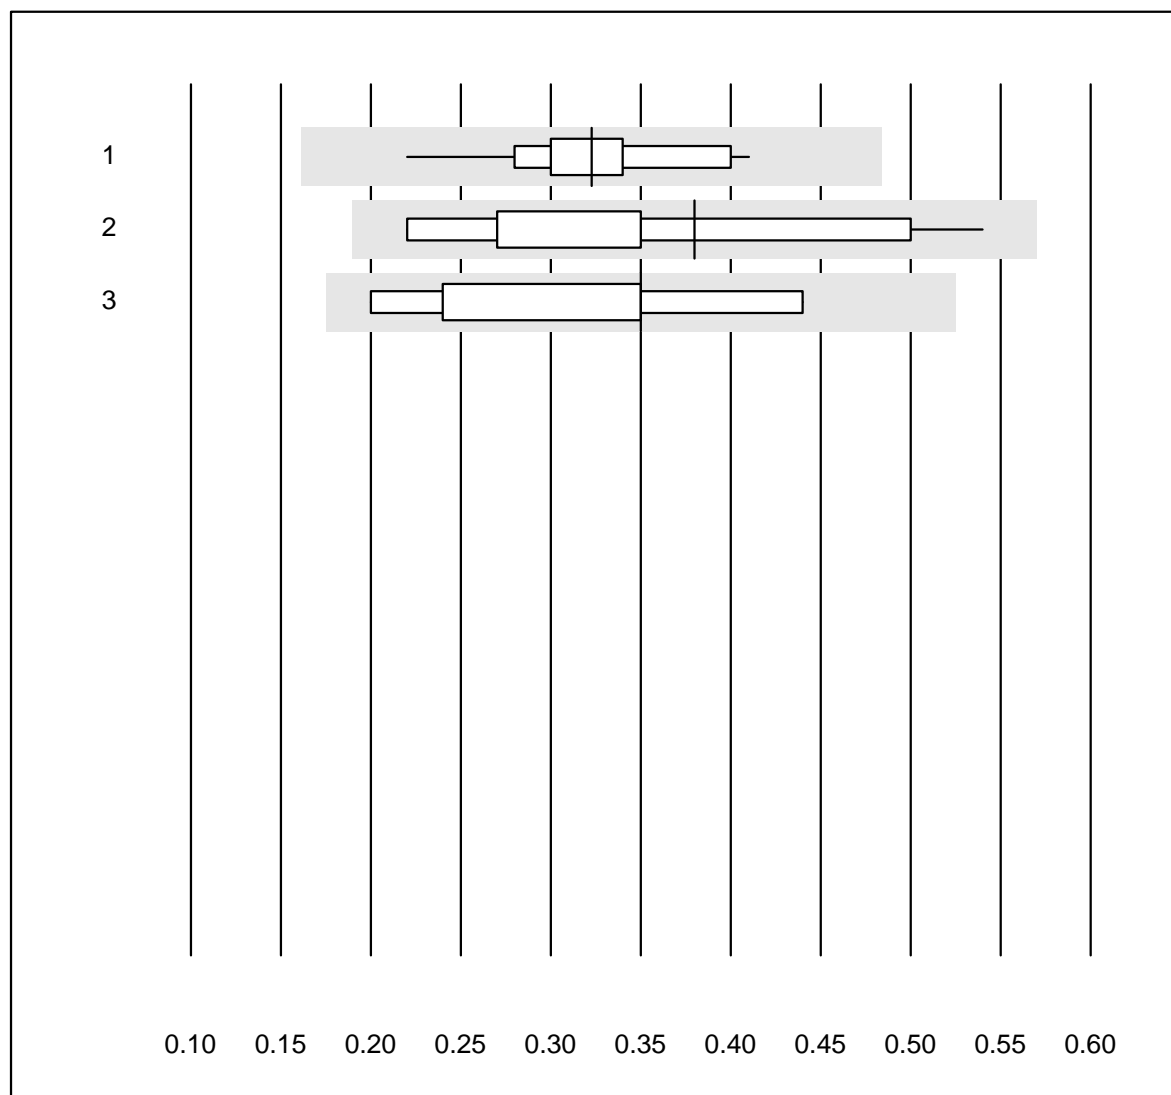


Tolérance MQ : 25 %

Monocytes (G/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Sysmex	43	100.0	0.0	0.0	0.32	13.2	a
2	Advia	12	100.0	0.0	0.0	0.38	29.1	a
3	ABX Pentra	9	88.9	0.0	11.1	0.35	24.9	a

Eosinophiles

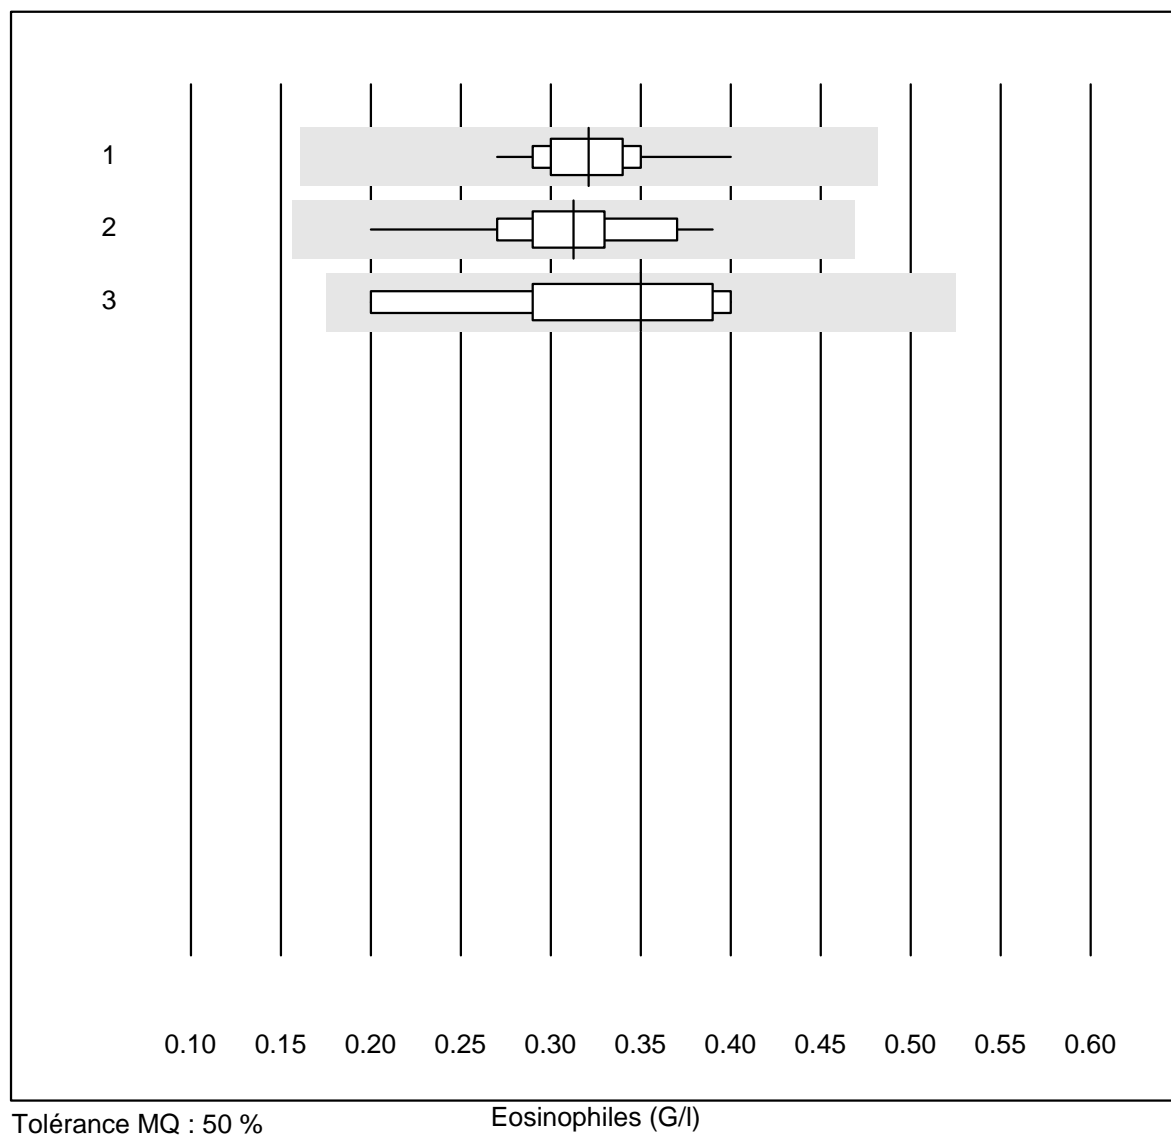

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Sysmex	43	100.0	0.0	0.0	0.32	8.6	e
2 Advia	12	100.0	0.0	0.0	0.31	15.7	e
3 ABX Pentra	9	100.0	0.0	0.0	0.35	20.0	e*

Basophiles

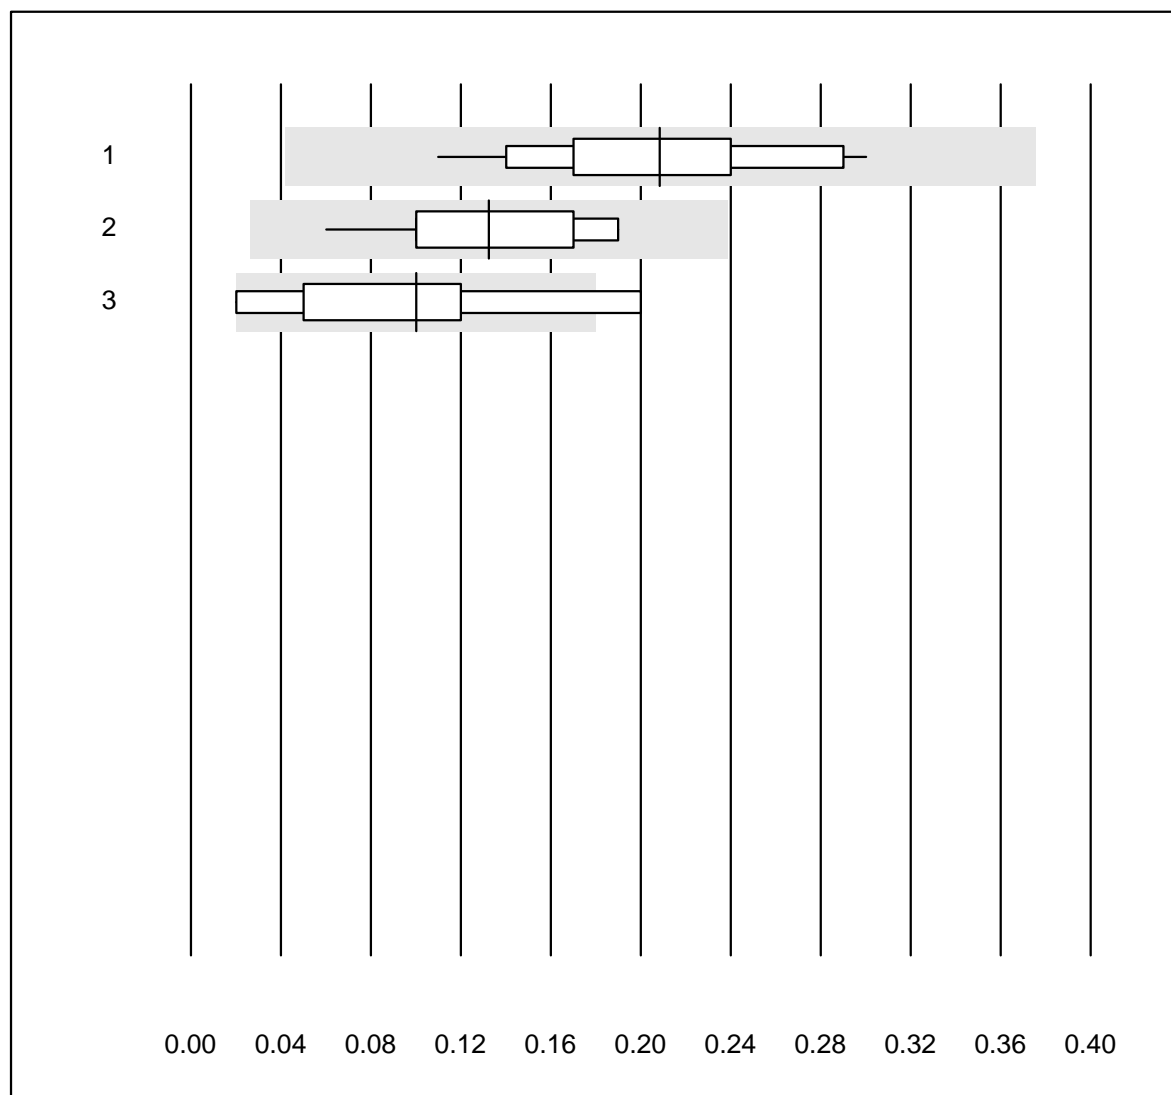


Tolérance MQ : 80 %

Basophiles (G/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Sysmex	43	100.0	0.0	0.0	0.21	23.2	e
2	Advia	12	100.0	0.0	0.0	0.13	30.9	e
3	ABX Pentra	9	55.6	33.3	11.1	0.10	55.3	a

Réticulocytes

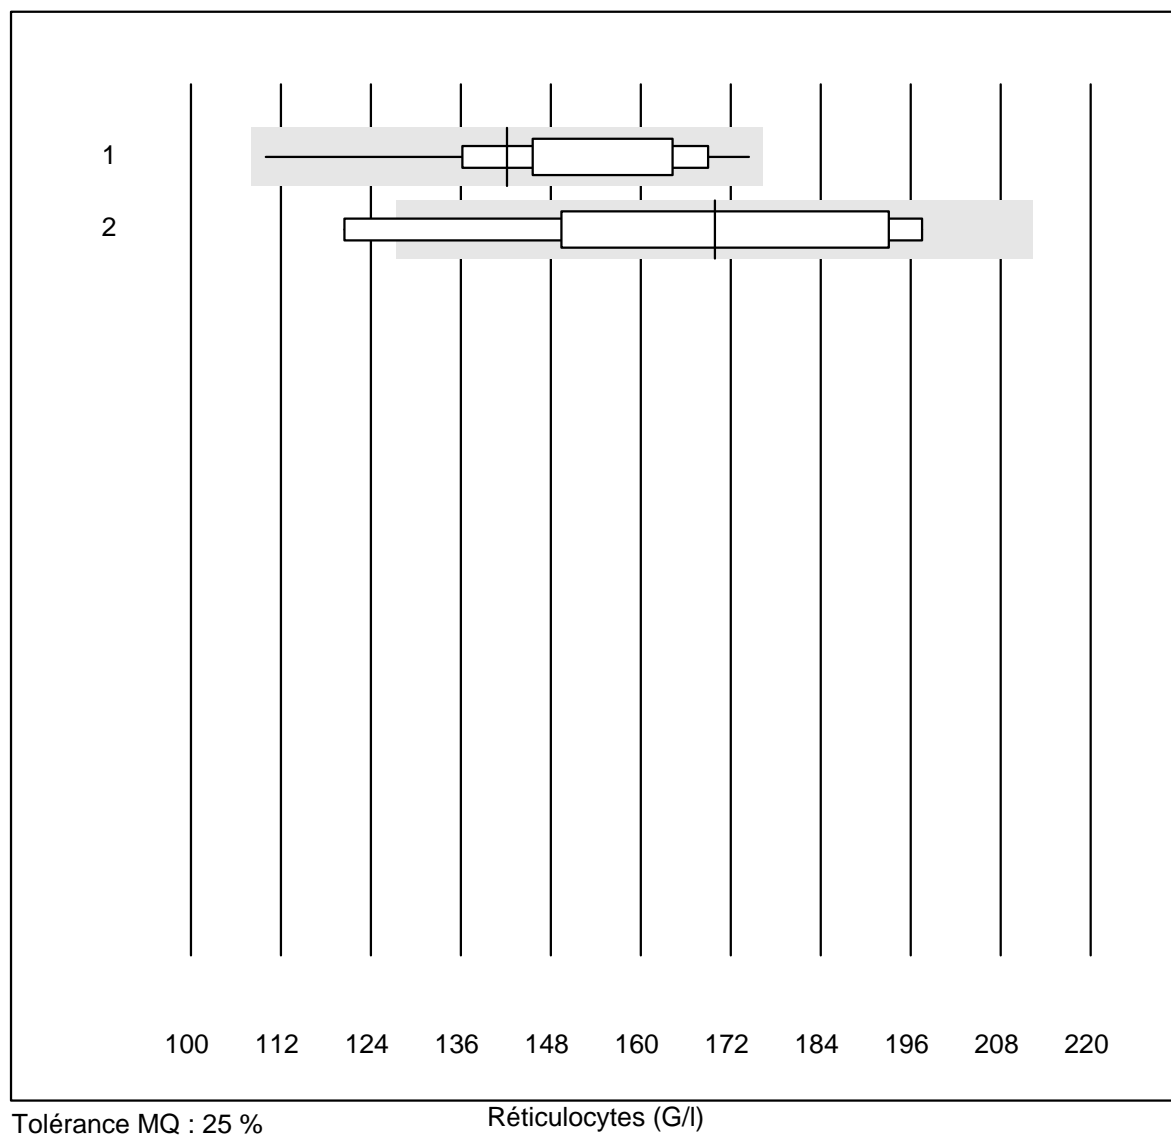

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Sysmex	23	100.0	0.0	0.0	142.2	10.6	a
2 Advia	9	88.9	11.1	0.0	169.9	16.3	e*

Index hémolytique échantillon A

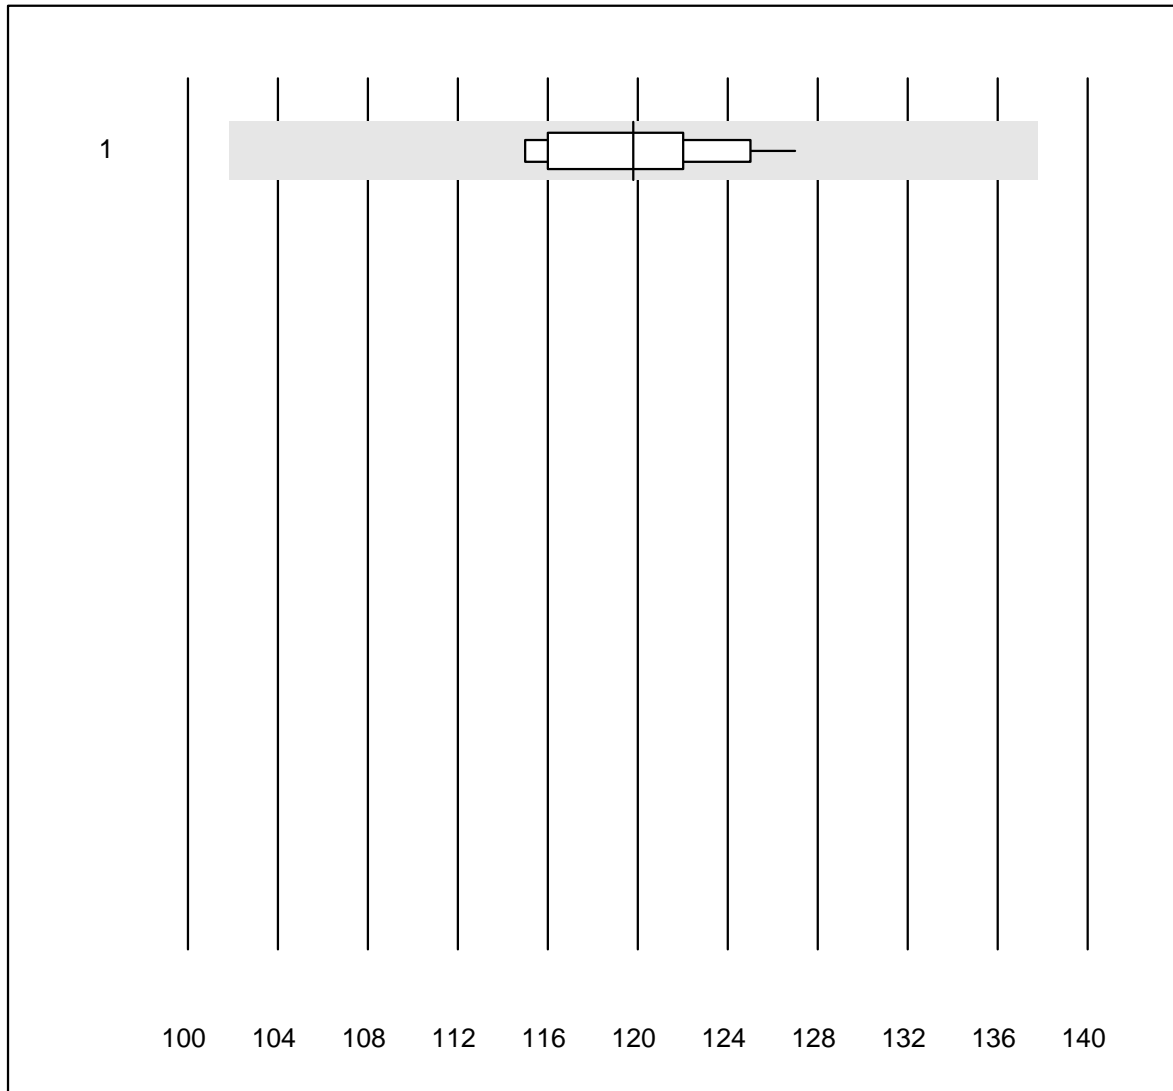


Tolérance MQ : 15 %

Index hémolytique échantillon A ()

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas	15	100.0	0.0	0.0	119.8	2.9	e

Index hémolytique échantillon B

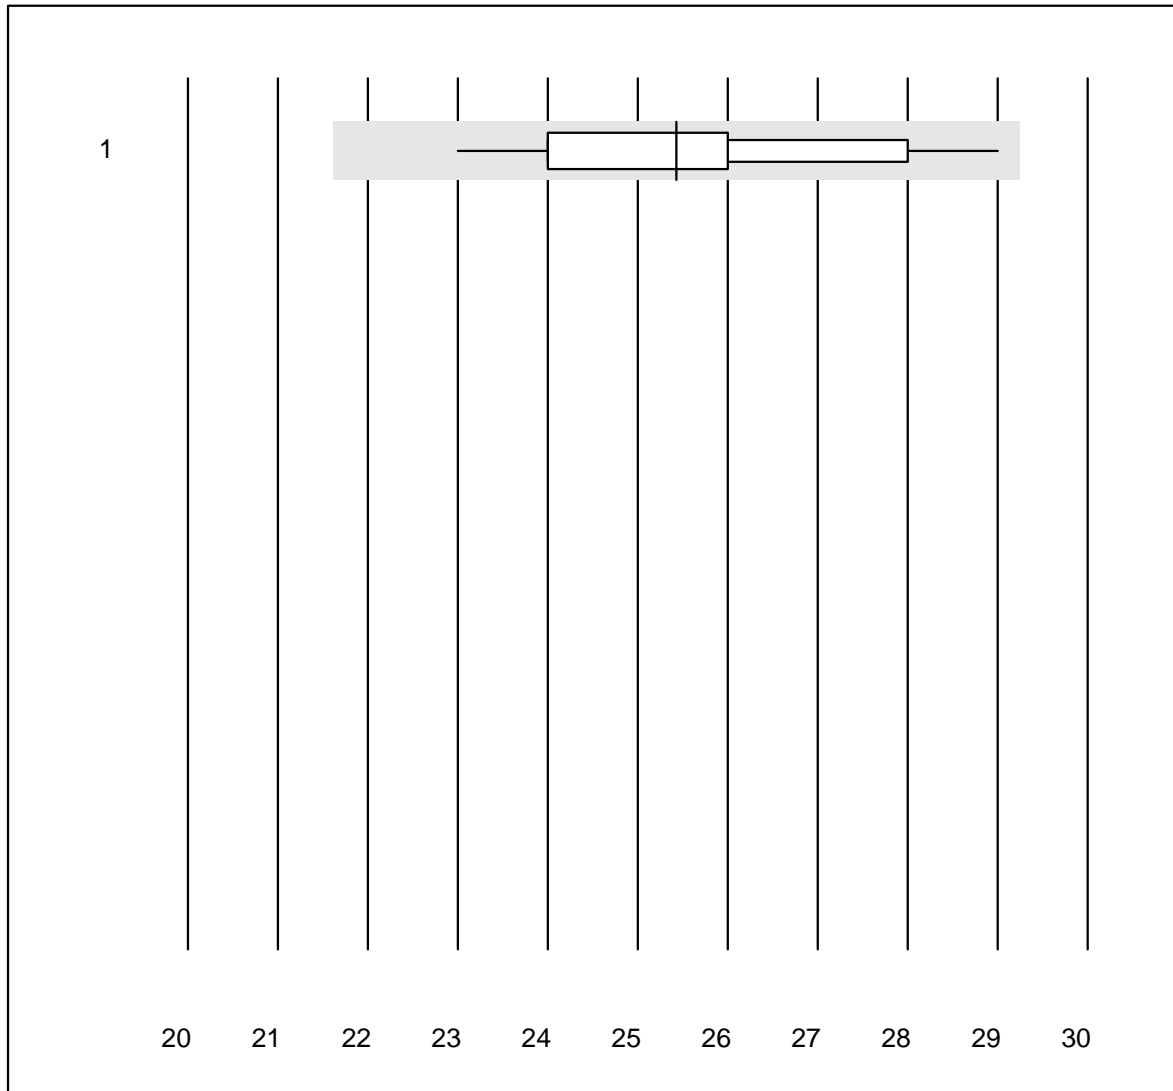


Tolérance MQ : 15 %

Index hémolytique échantillon B ()

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas	15	93.3	0.0	6.7	25.4	6.3	e

Vitesse de sédimentation 1h

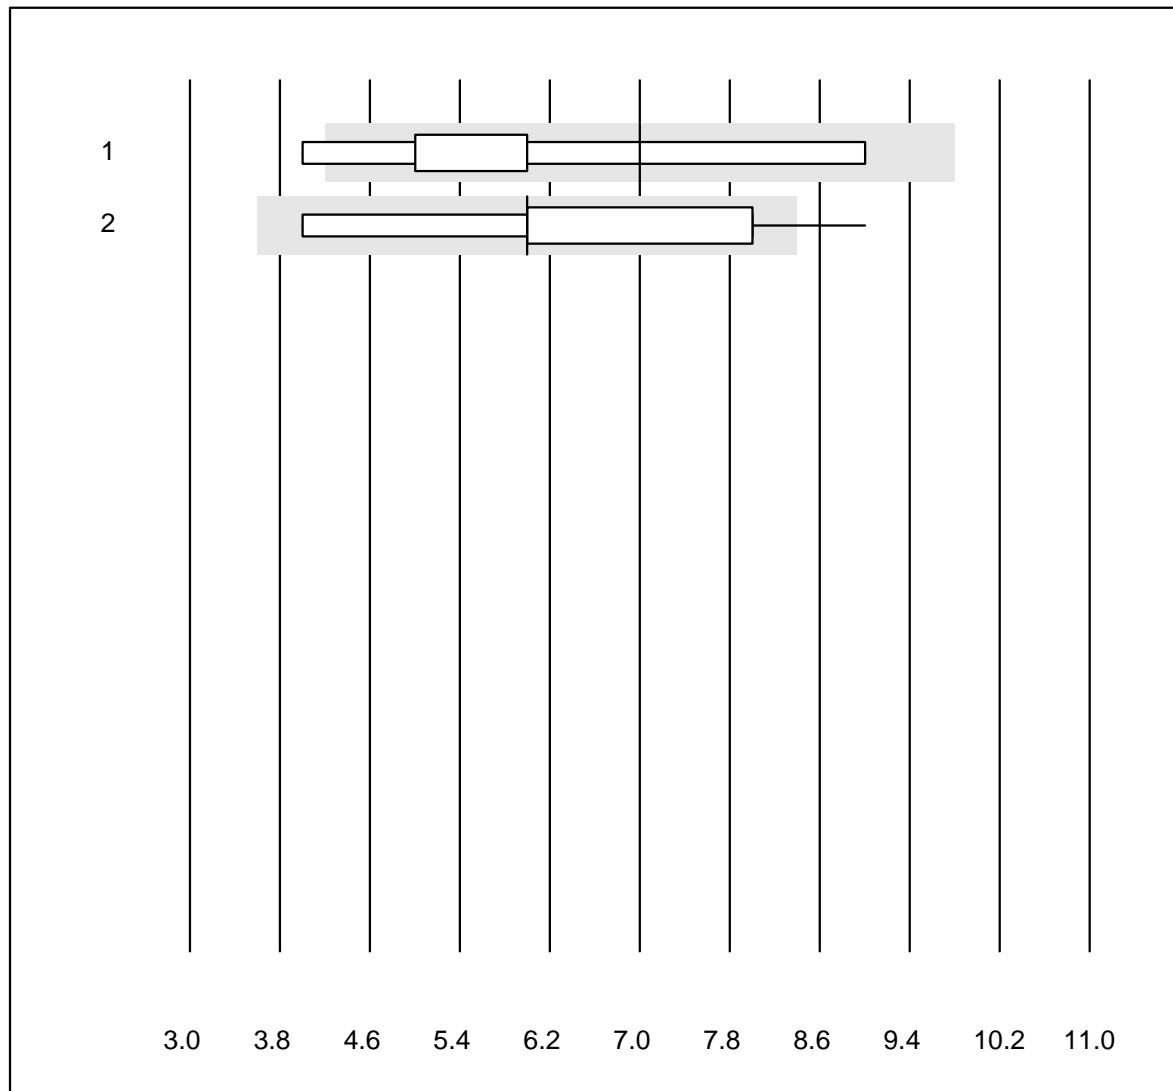


Tolérance MQ : 30 %

Vitesse de sédimentation 1h (mm/h)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Sarstedt Sedivette	10	70.0	10.0	20.0	7	27.7	a
2	BD Seditainer	14	85.8	7.1	7.1	6	23.0	a

Vitesse de sédimentation 2h

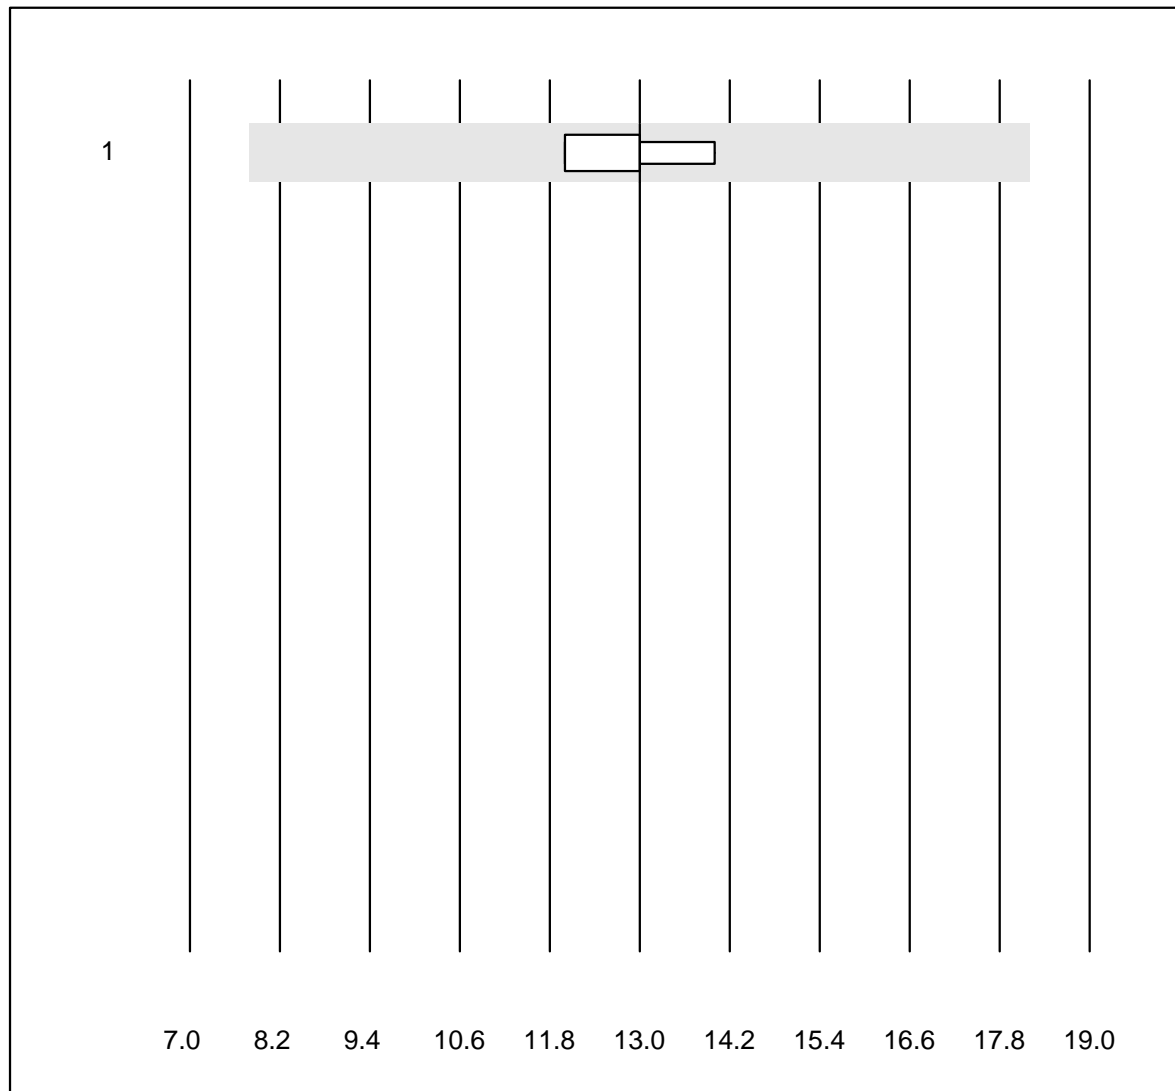


Tolérance MQ : 30 %

Vitesse de sédimentation 2h (mm/2h)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	BD Seditainer	4	100.0	0.0	0.0	13	7.5	a

CRP

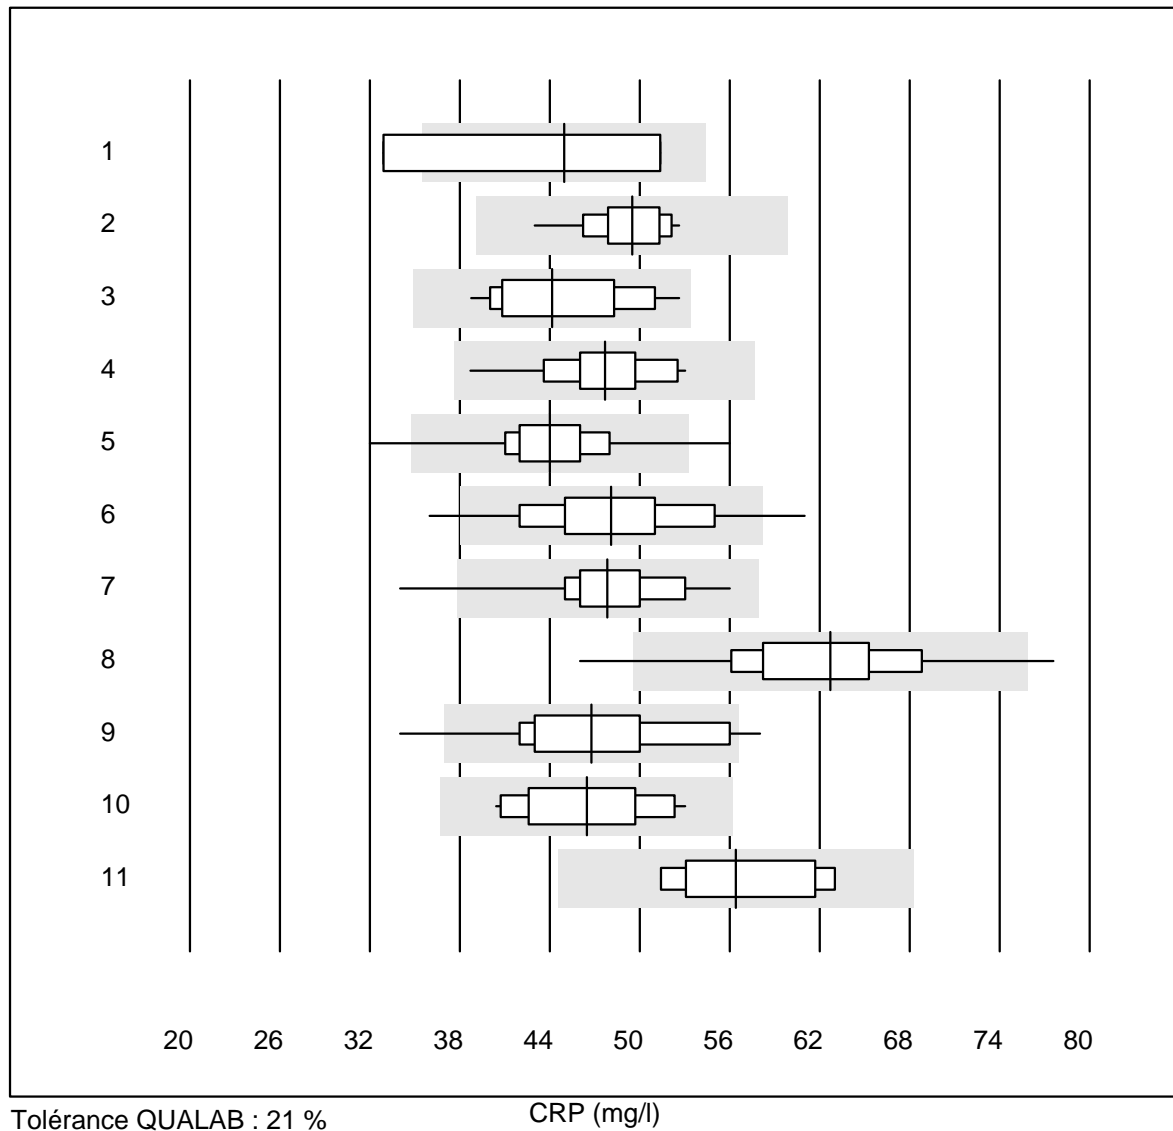


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 IChroma	4	50.0	25.0	25.0	44.9	23.1	e*
2 Celltac chemi	15	100.0	0.0	0.0	49.5	5.1	e
3 Cobas	15	100.0	0.0	0.0	44.1	9.7	e
4 Turbidimétrie	39	94.9	0.0	5.1	47.7	6.7	e
5 Afinion	1366	99.5	0.4	0.1	44.0	6.5	e
6 NycoCard SingleTest-	241	86.3	3.3	10.4	48.1	10.6	e
7 Quick Read go	182	97.3	1.1	1.6	47.8	6.9	e
8 Eurolyser	124	83.9	4.8	11.3	62.7	10.0	e
9 Fuji Dri-Chem	23	82.7	13.0	4.3	46.8	12.4	e*
10 Autolyser/DiaSys	11	100.0	0.0	0.0	46.5	9.2	e*
11 Piccolo	7	100.0	0.0	0.0	56.4	7.6	e*

CRP

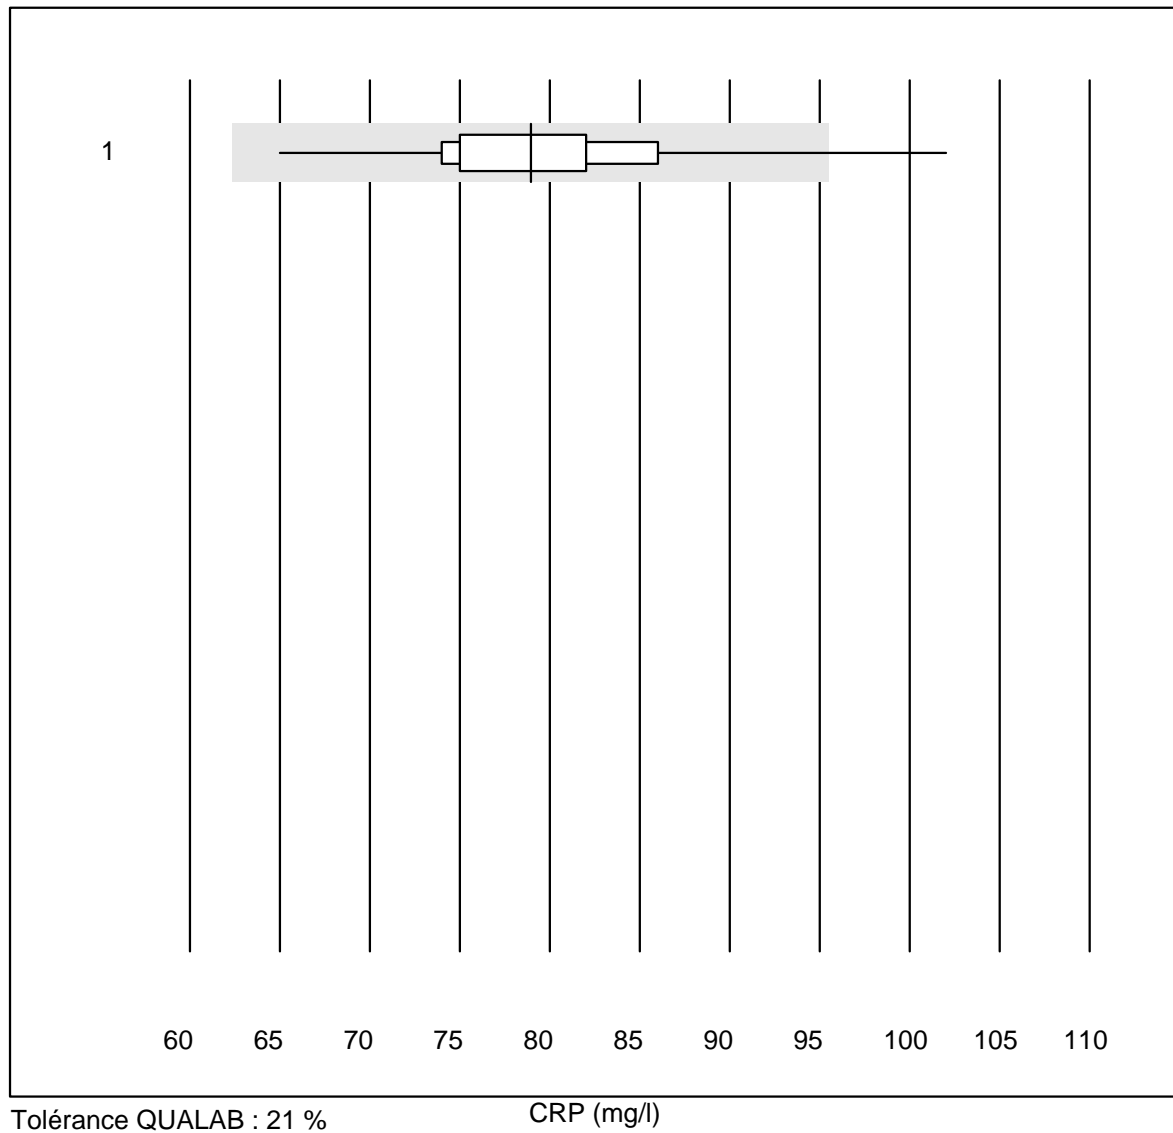


No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 QuickRead (sang comp	104	98.0	1.0	1.0	78.9	7.2	e

CRP

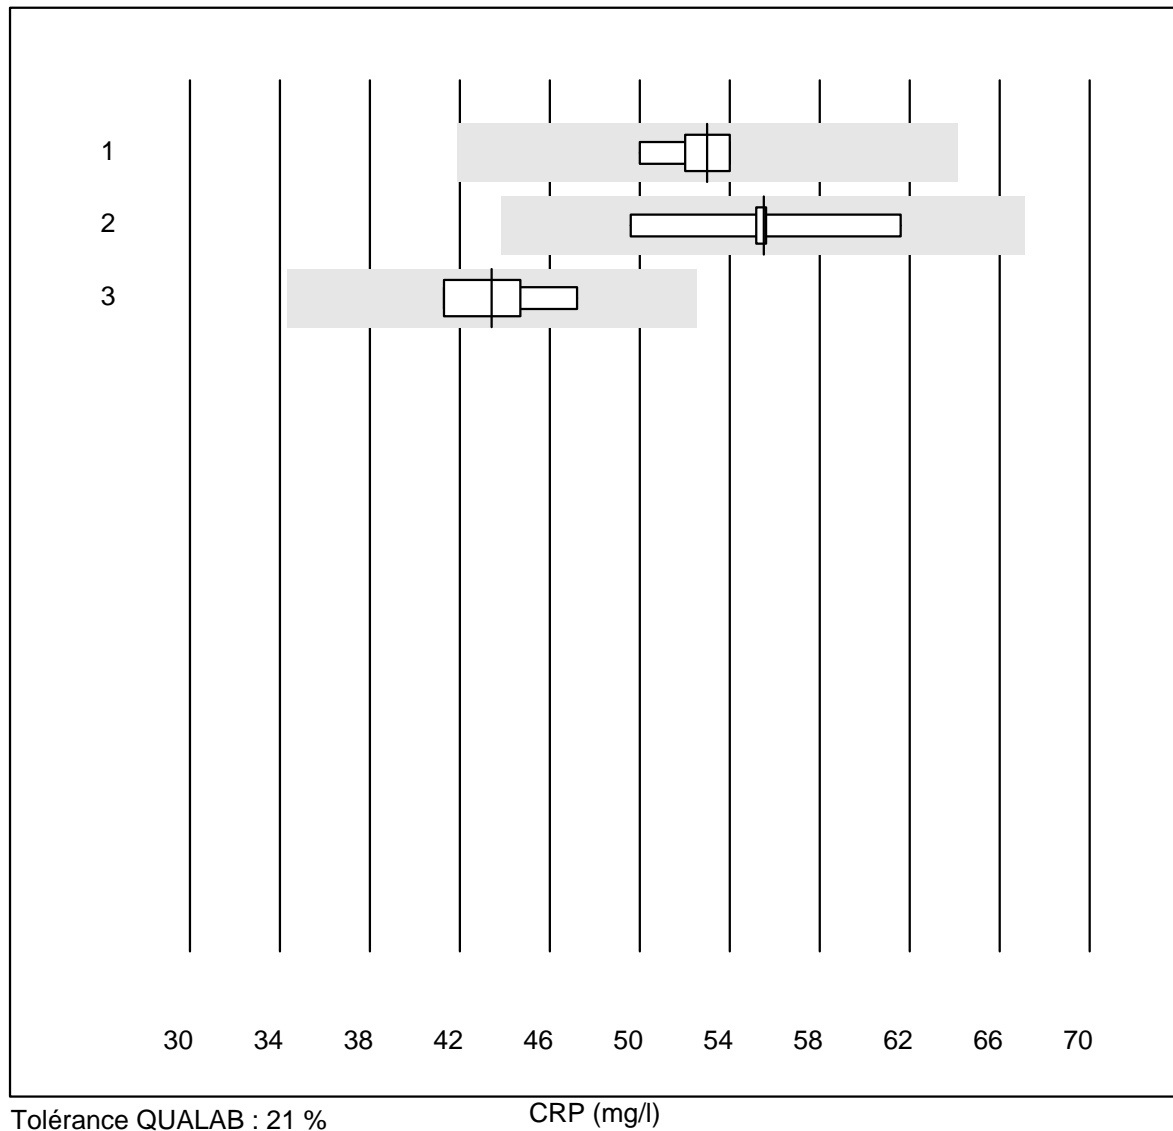

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	AQT 90 FLEX	7	100.0	0.0	0.0	53.0	2.8	e
2	Spotchem D-Concept	5	100.0	0.0	0.0	55.5	7.7	e*
3	Spotchem SI-3510	4	100.0	0.0	0.0	43.4	6.1	e*

IgG

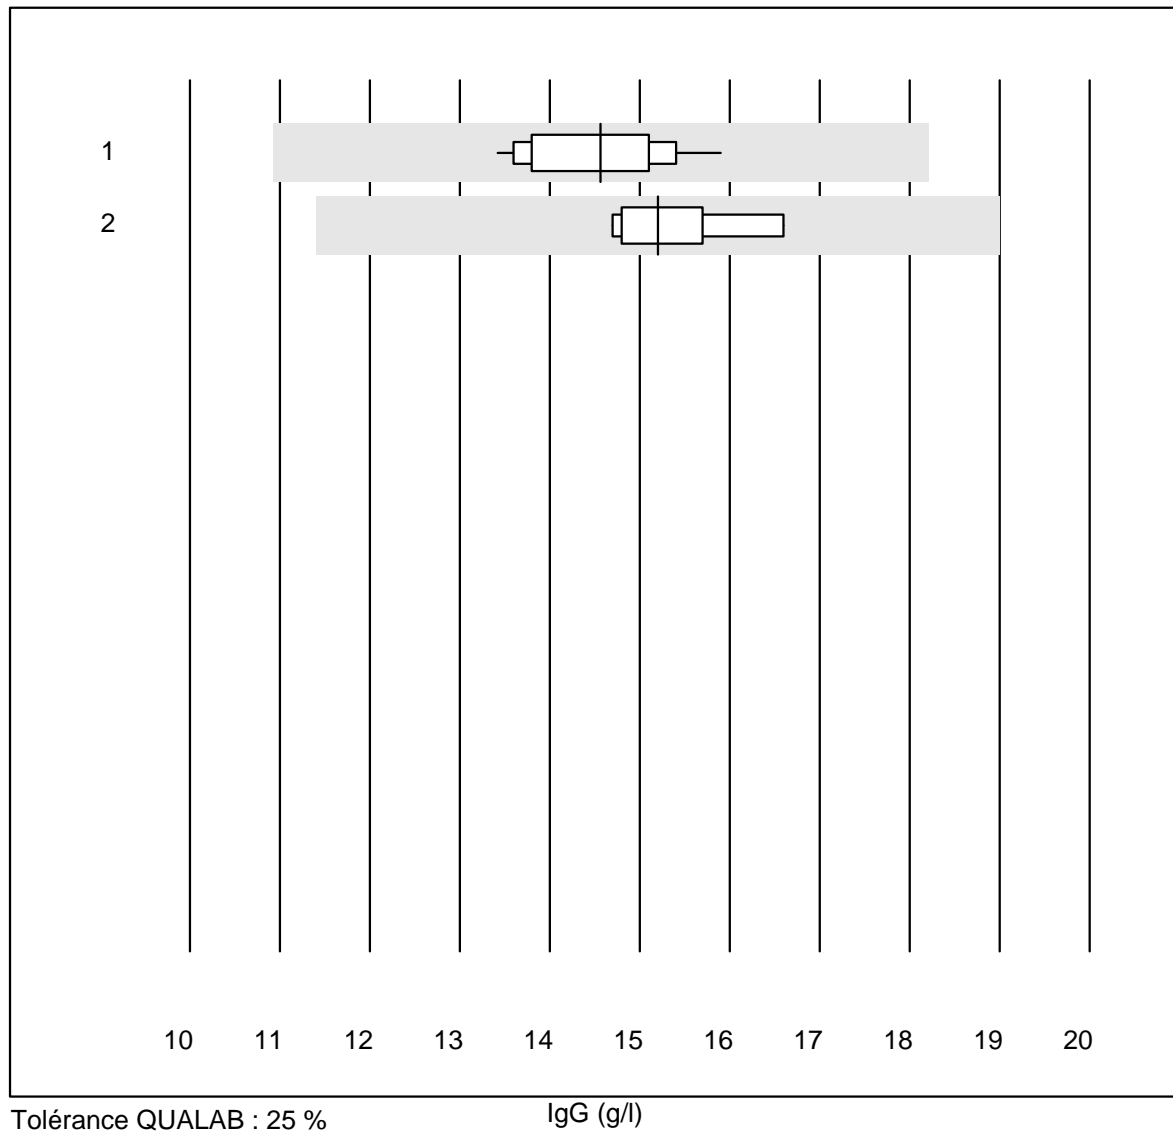


Tolérance QUALAB : 25 %

IgG (g/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Turbidimétrie	13	100.0	0.0	0.0	14.6	5.3	e
2	Néphélométrie	8	100.0	0.0	0.0	15.2	4.4	e

IgA

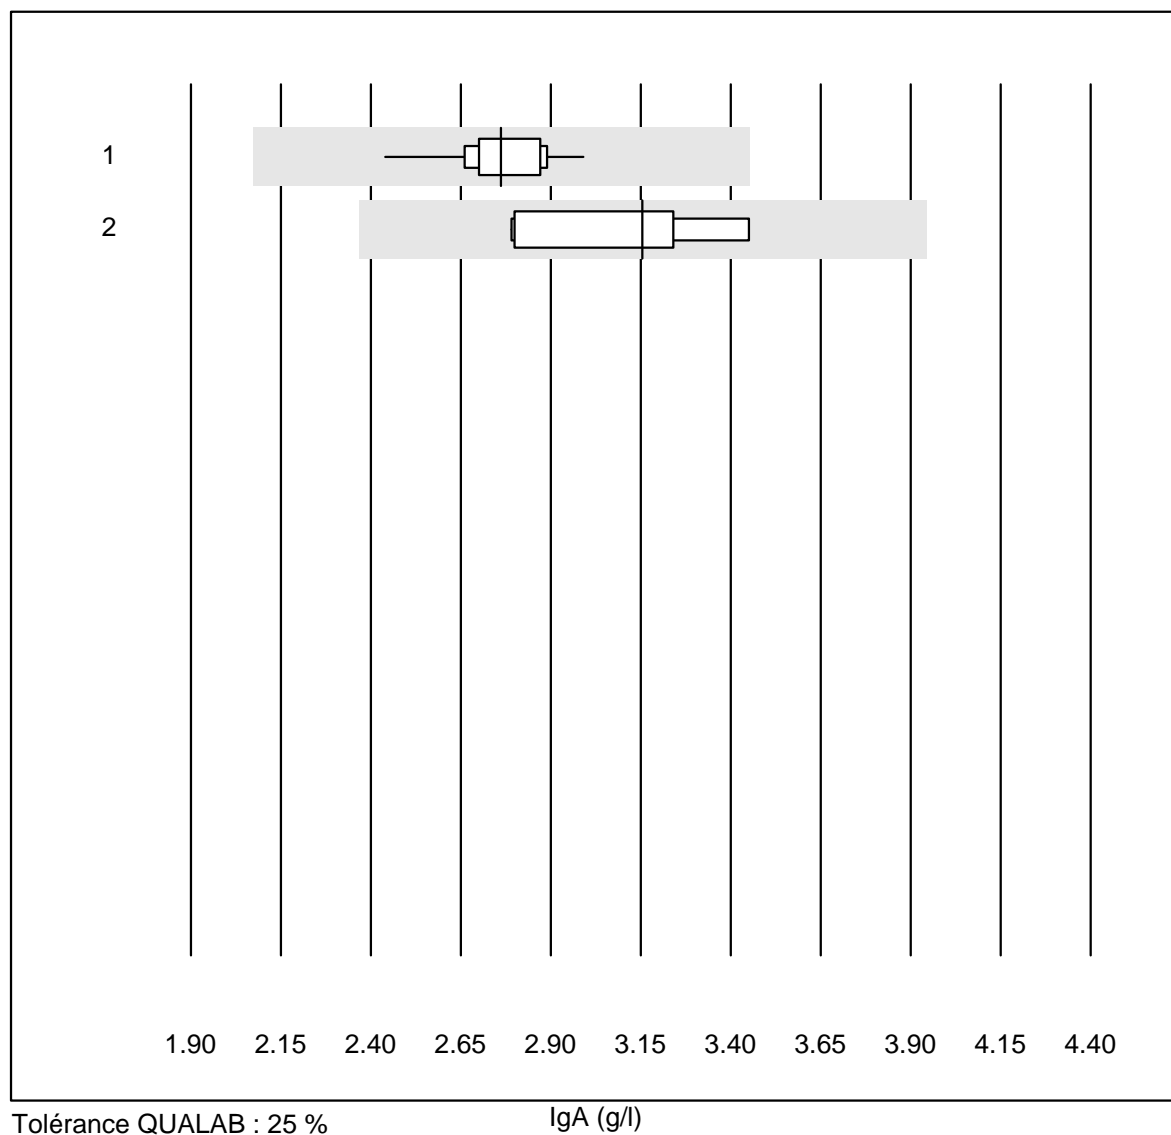

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Turbidimétrie	13	100.0	0.0	0.0	2.8	5.0	e
2 Néphélométrie	8	100.0	0.0	0.0	3.2	7.6	e

IgM

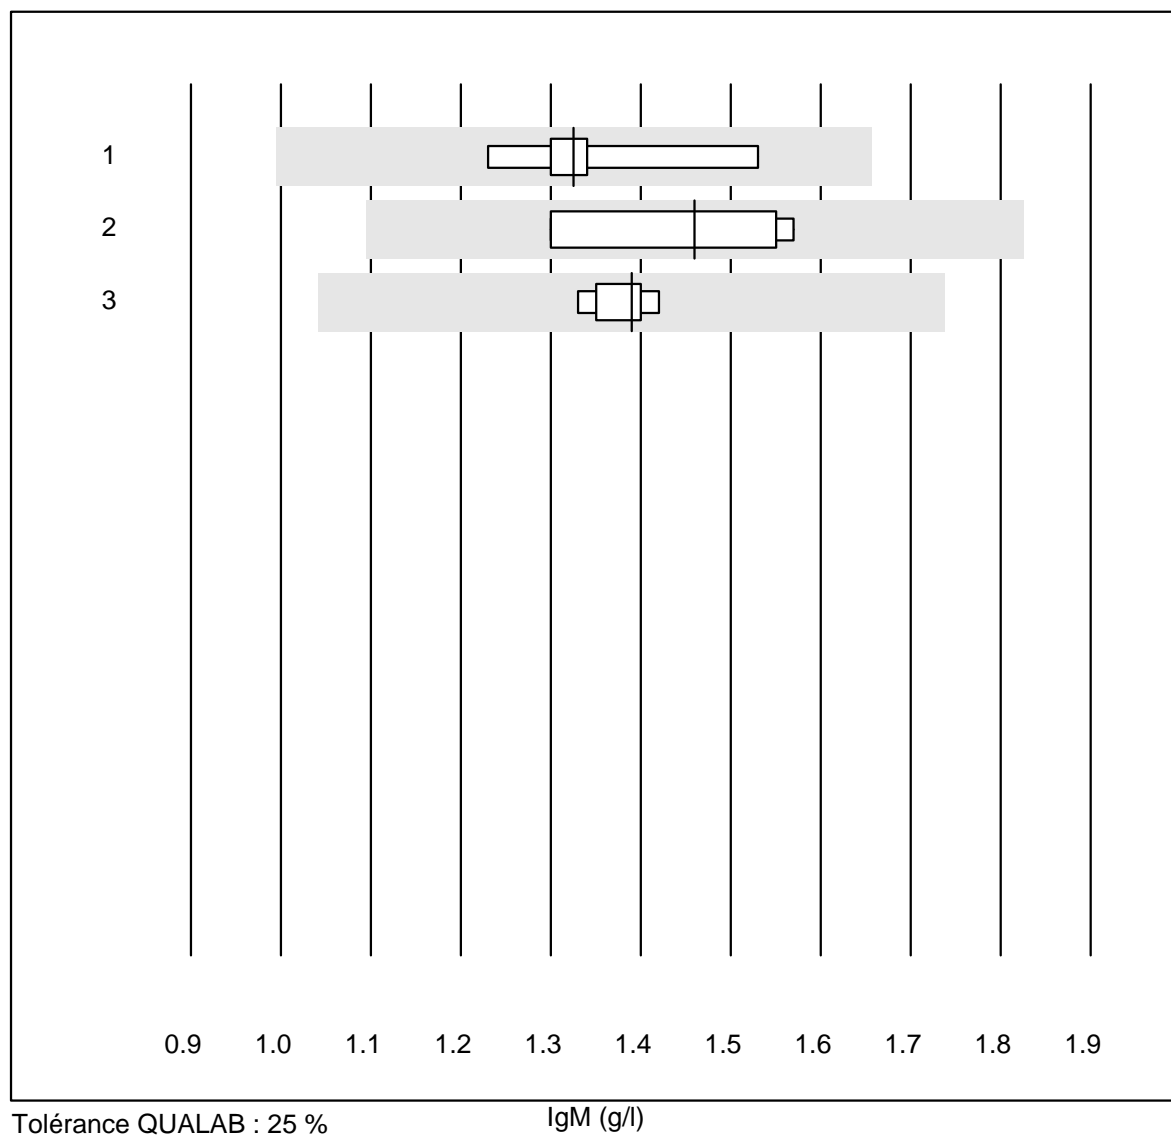


Tolérance QUALAB : 25 %

IgM (g/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Turbidimetrie	8	100.0	0.0	0.0	1.3	6.8	e
2	Nephelometrie	9	100.0	0.0	0.0	1.5	8.4	e
3	Cobas Integra 800/40	5	100.0	0.0	0.0	1.4	2.7	e

IgE

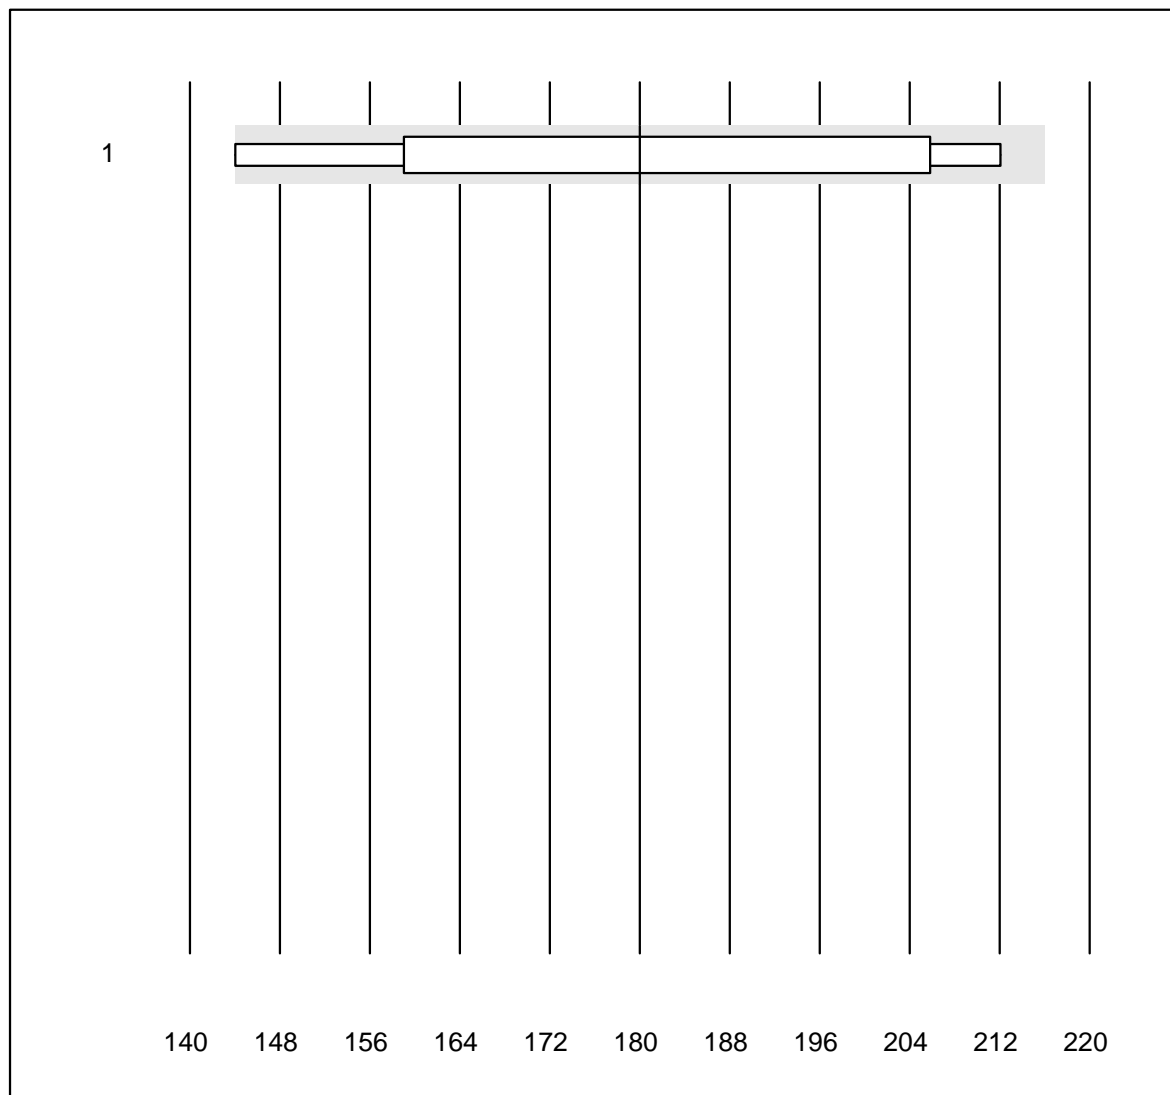


Tolérance QUALAB : 20 %

IgE (kU/L)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	10	80.0	10.0	10.0	180	14.0	e*

Alpha-1-Antitrypsine

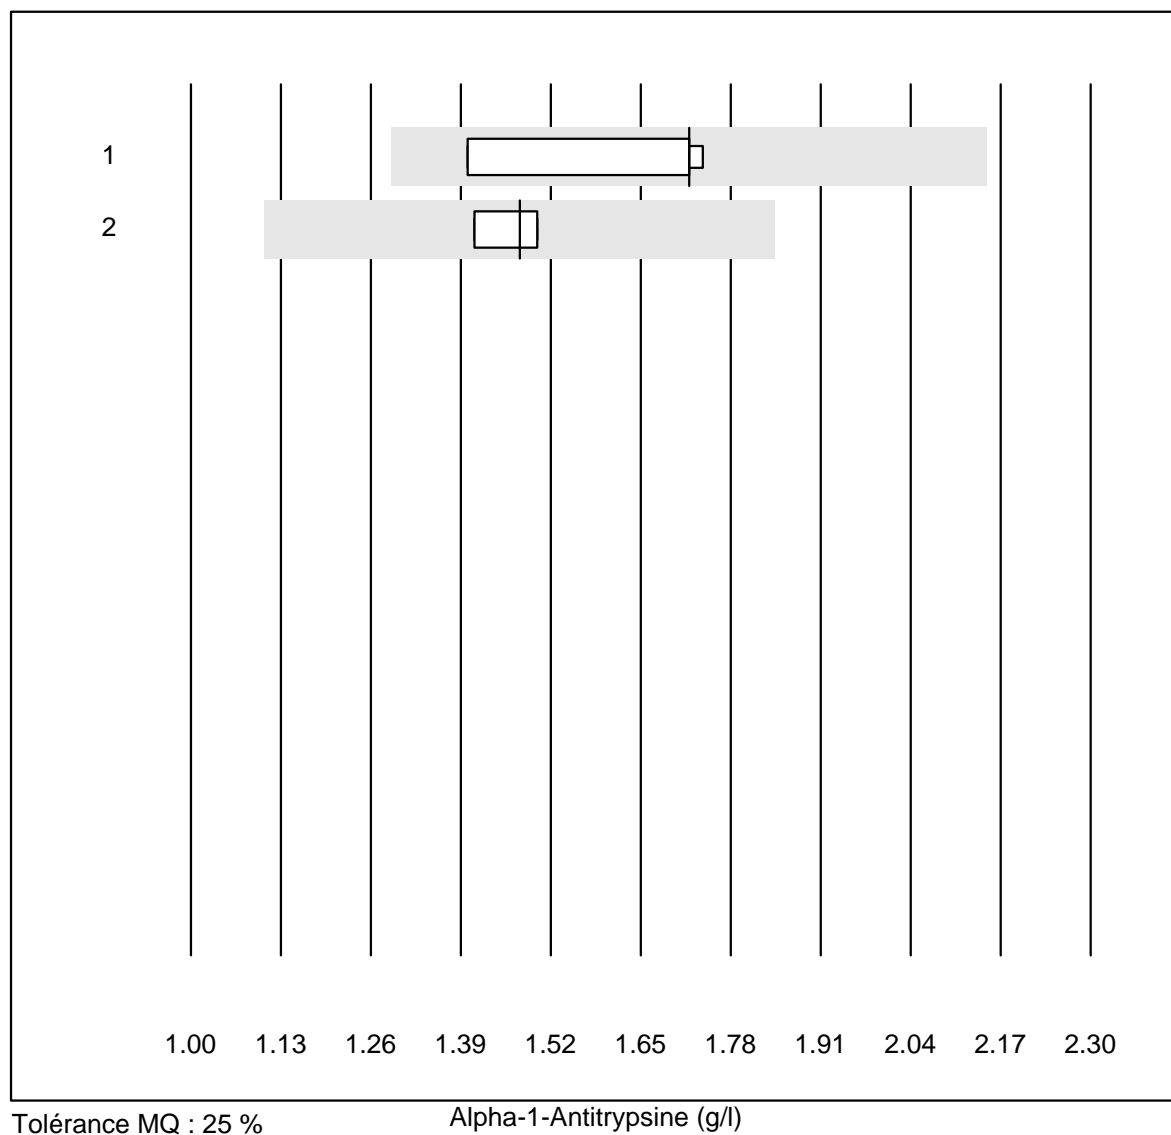


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Nephelometrie	4	100.0	0.0	0.0	1.72	9.9	e*
2	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	1.48	3.0	e

Anti-Streptolysine-Anticorps

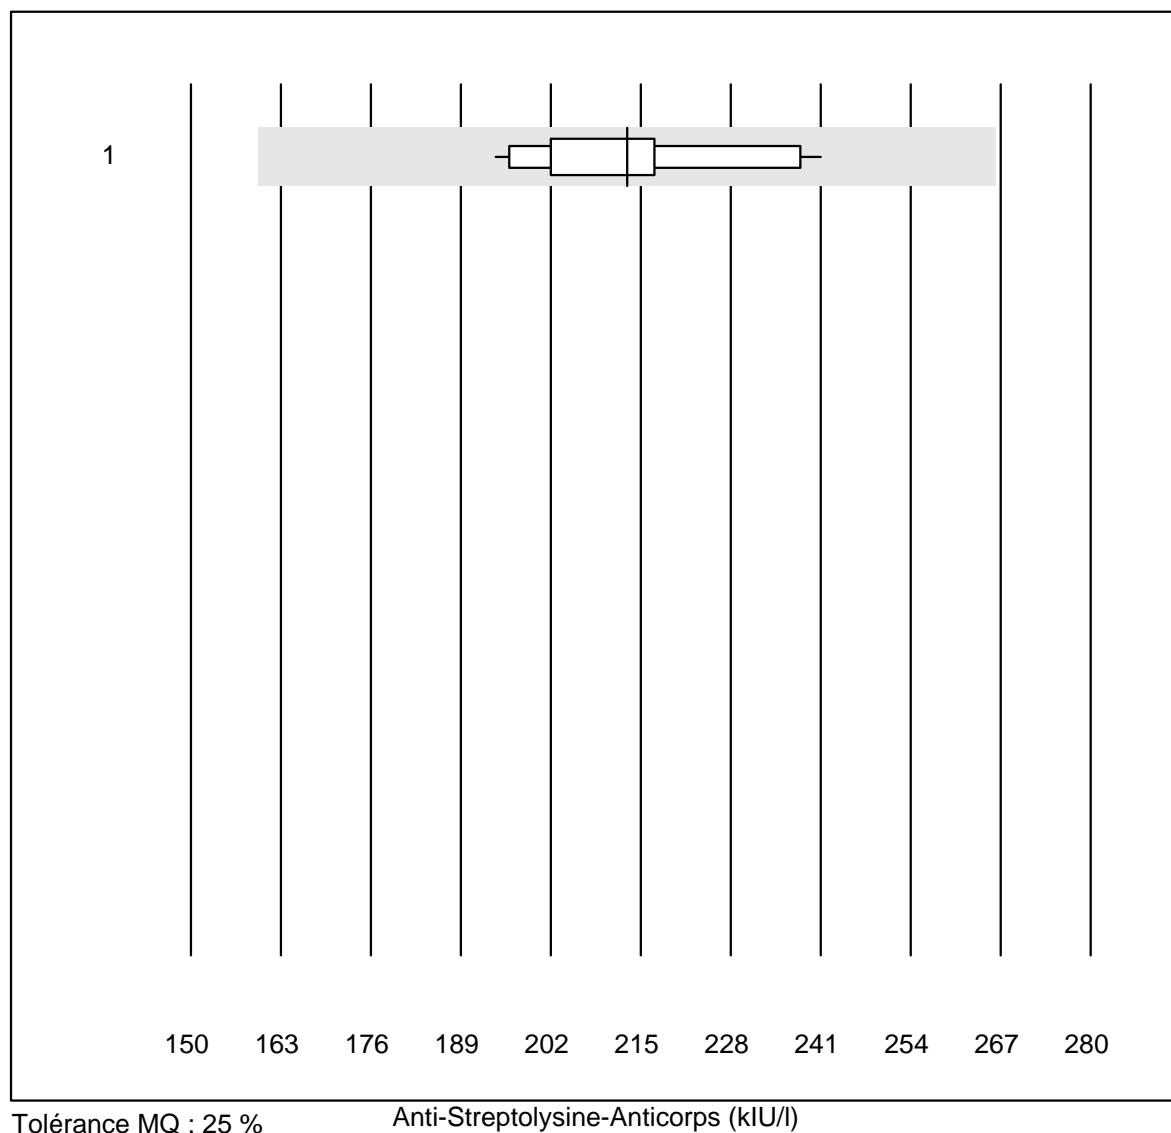


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	12	100.0	0.0	0.0	213	6.9 e

Complément C3

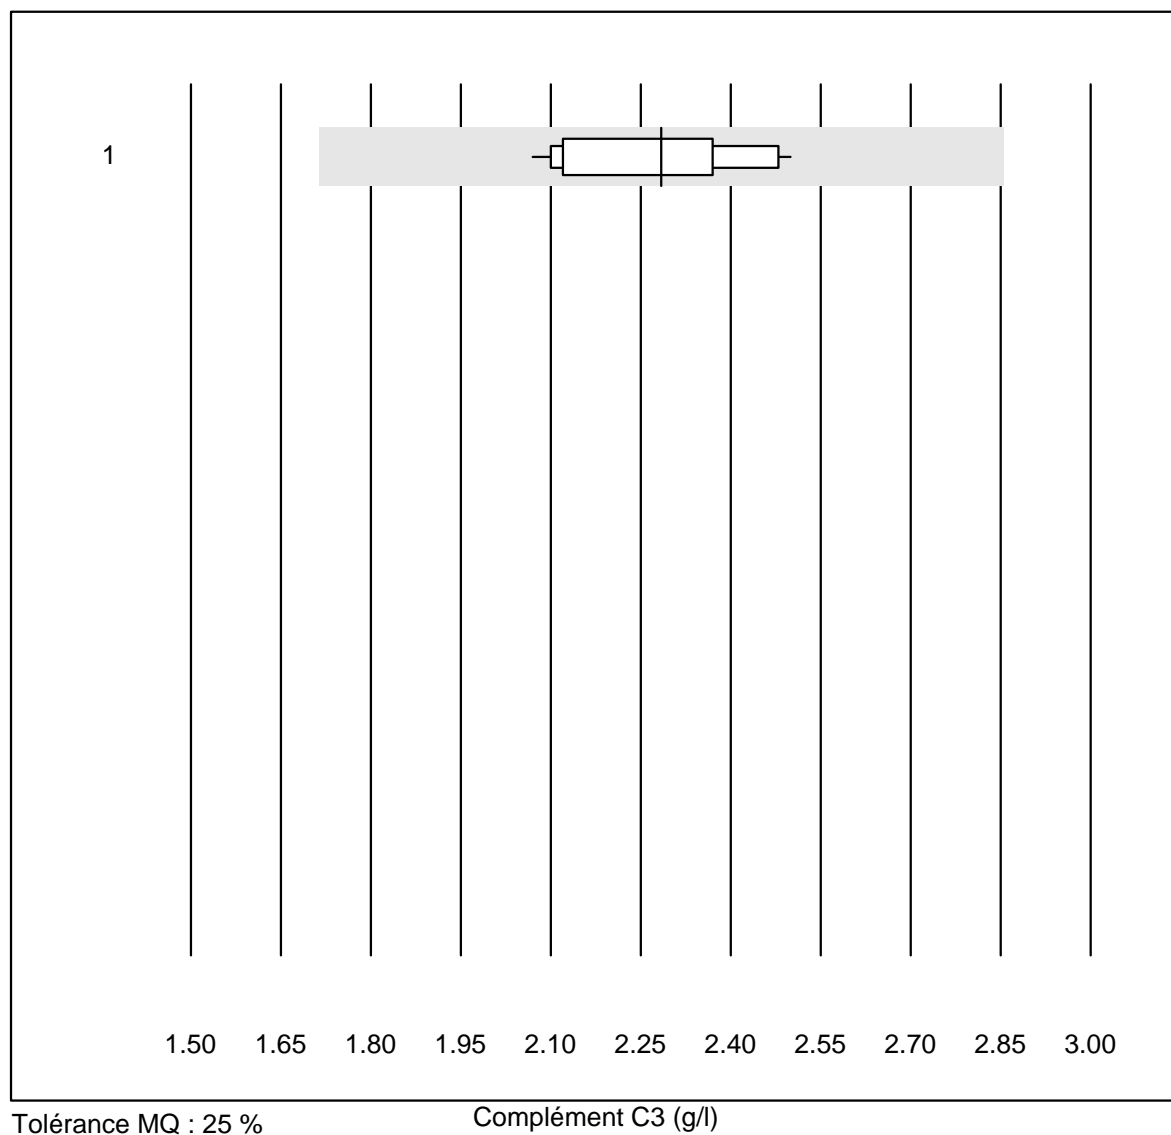


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 toutes les méthodes	12	100.0	0.0	0.0	2.28	6.5	e

Complément C4

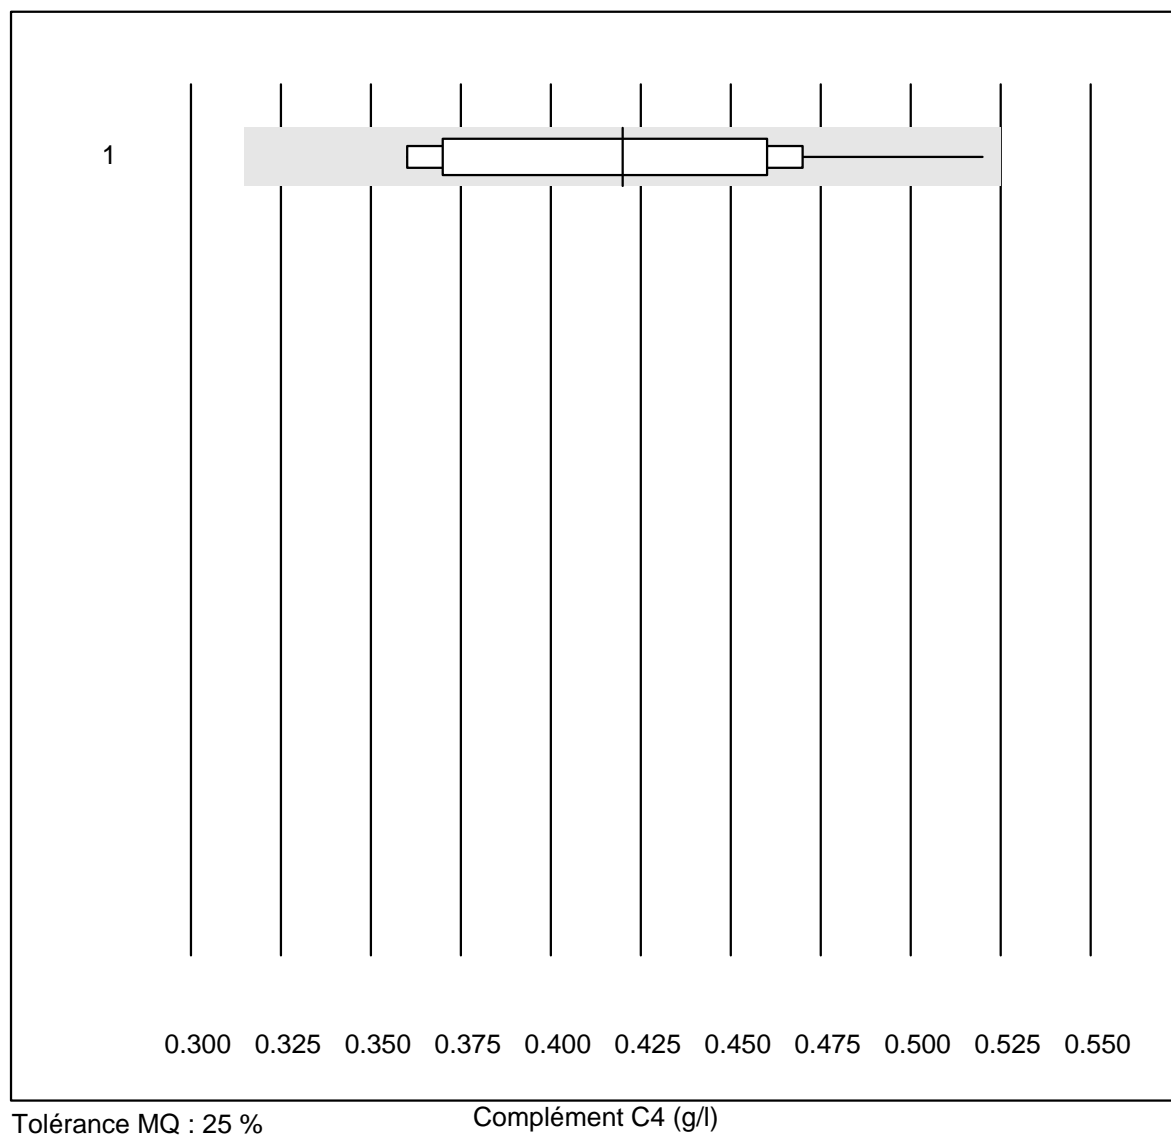


No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	11	100.0	0.0	0.0	0.42	12.1 e*

Haptoglobine

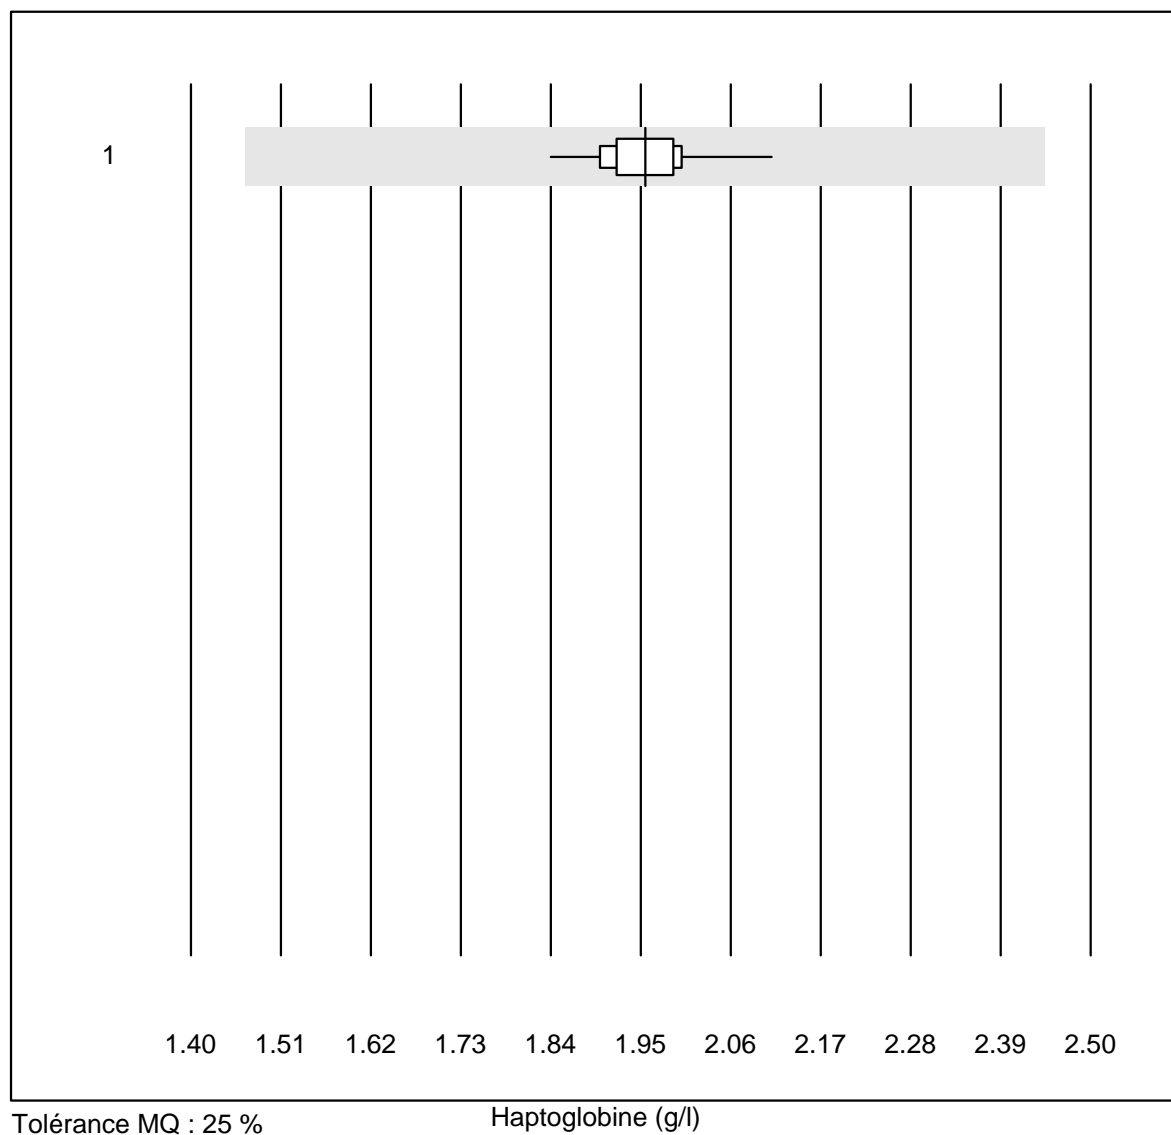


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	15	100.0	0.0	0.0	1.96	3.1	e

Transferrine

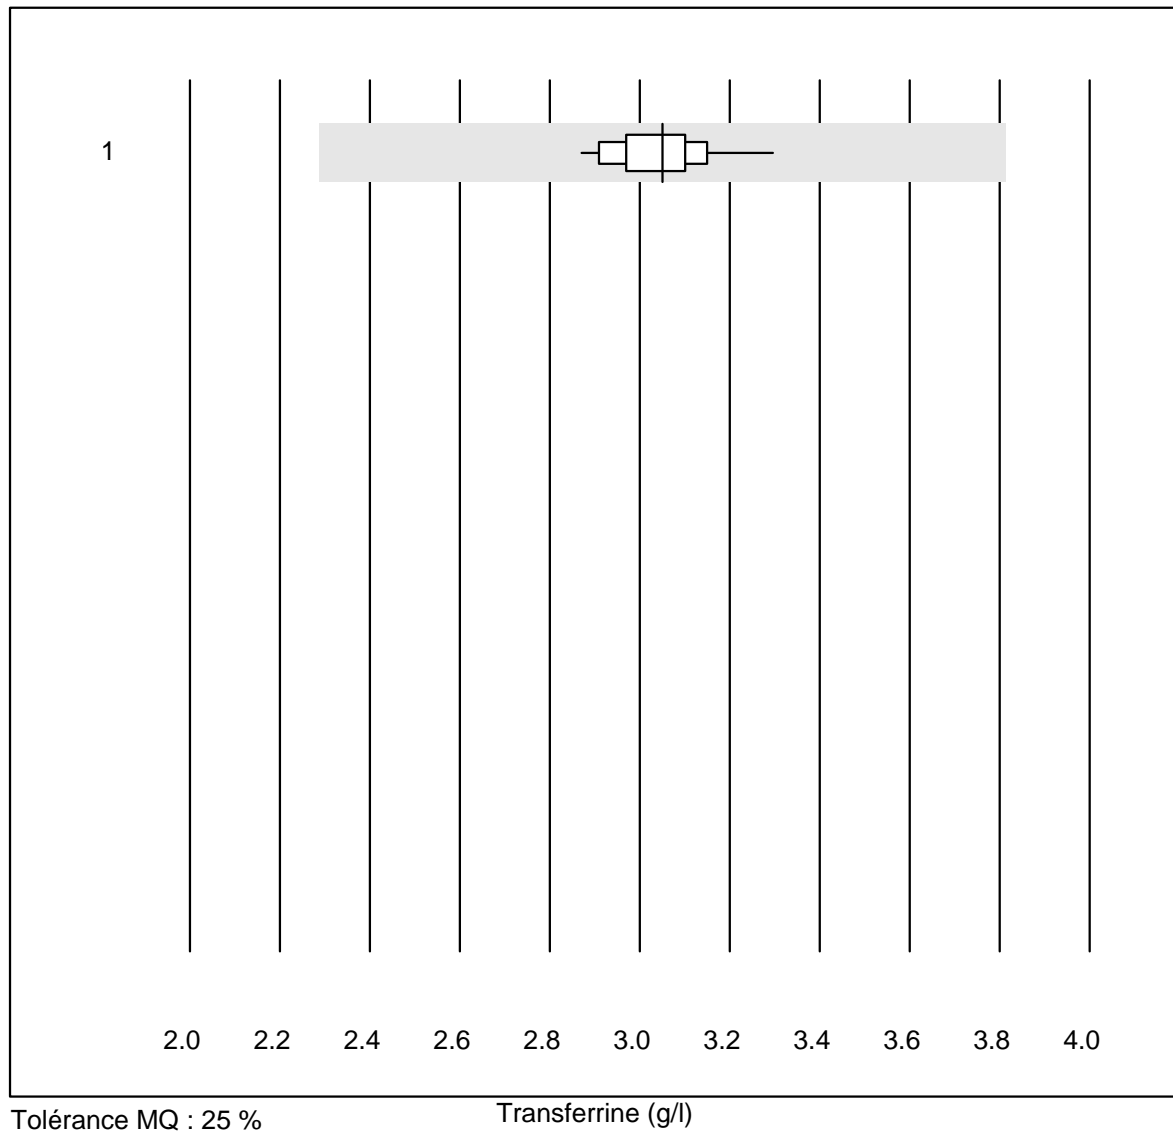


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	20	100.0	0.0	0.0	3.05	3.4	e

Beta-2-Mikroglobulin

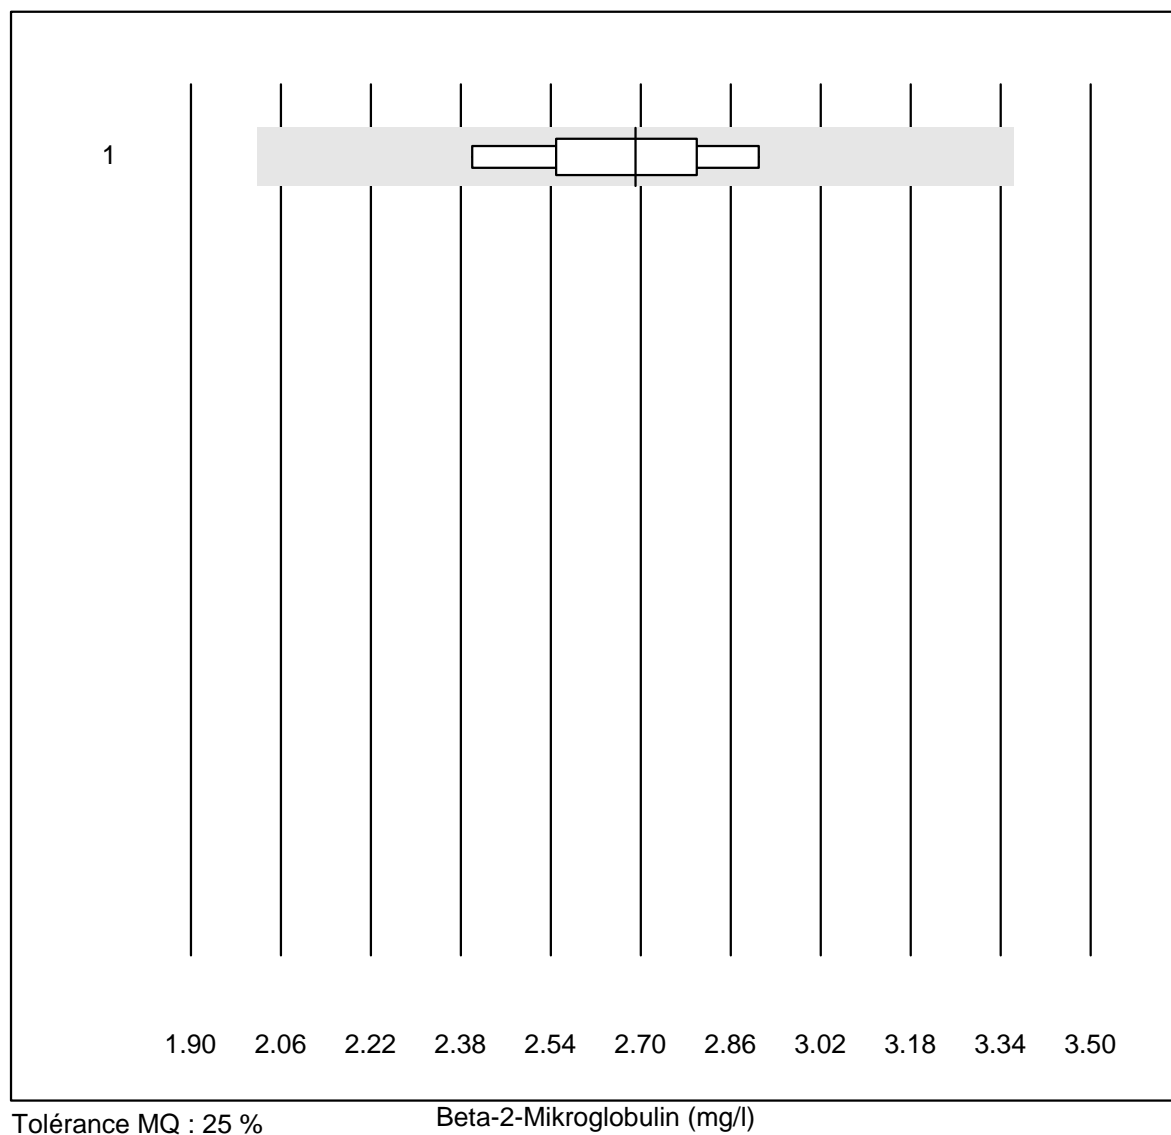

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	2.69	7.5	e*

Facteur rhumatoïde

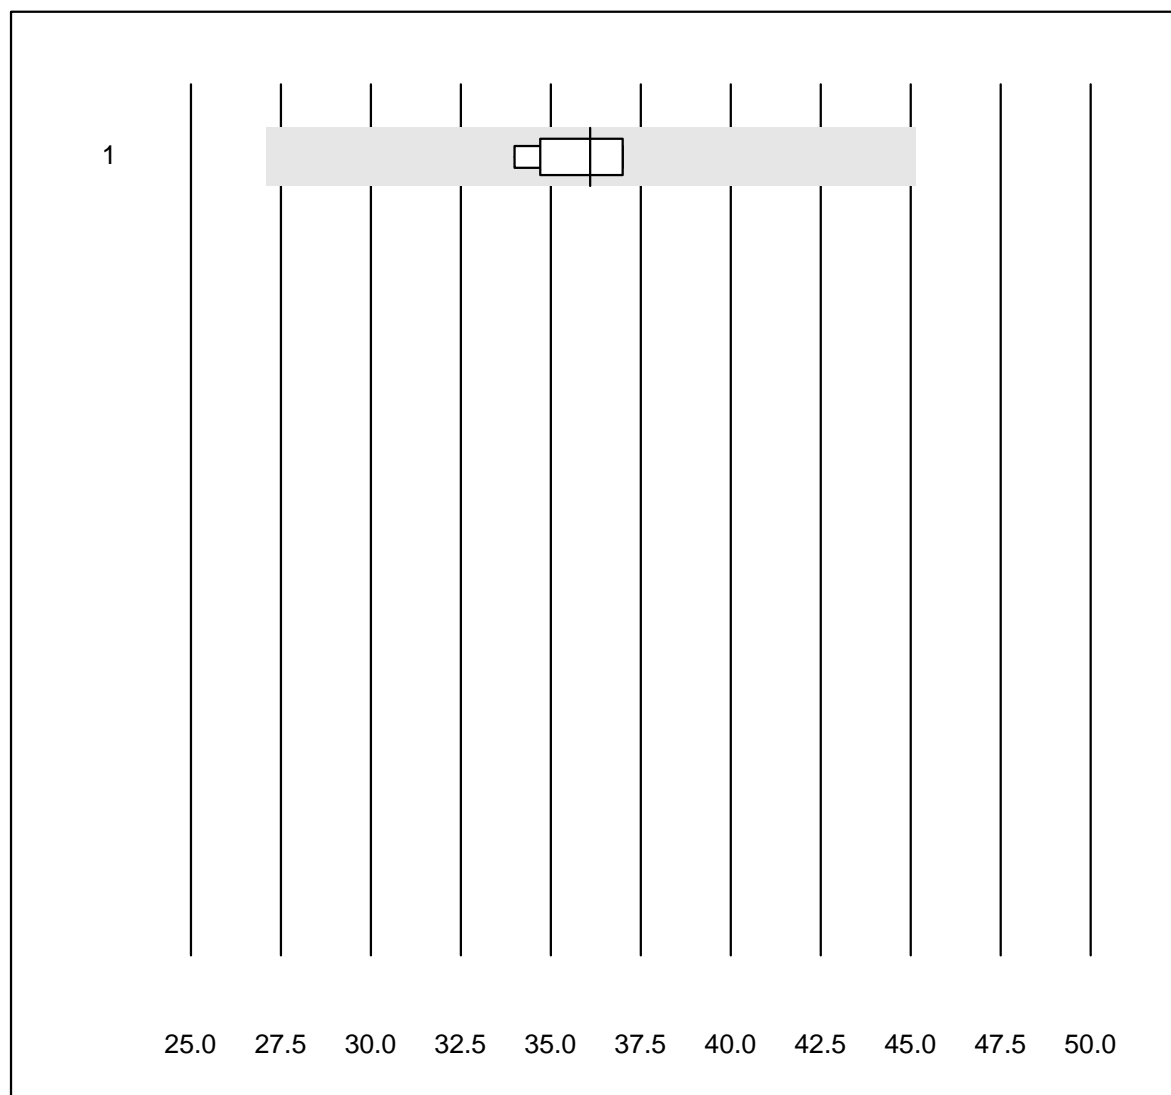


Tolérance MQ : 25 %

Facteur rhumatoïde (U/ml)


No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	36.1	3.8	e

Ceruloplasmin

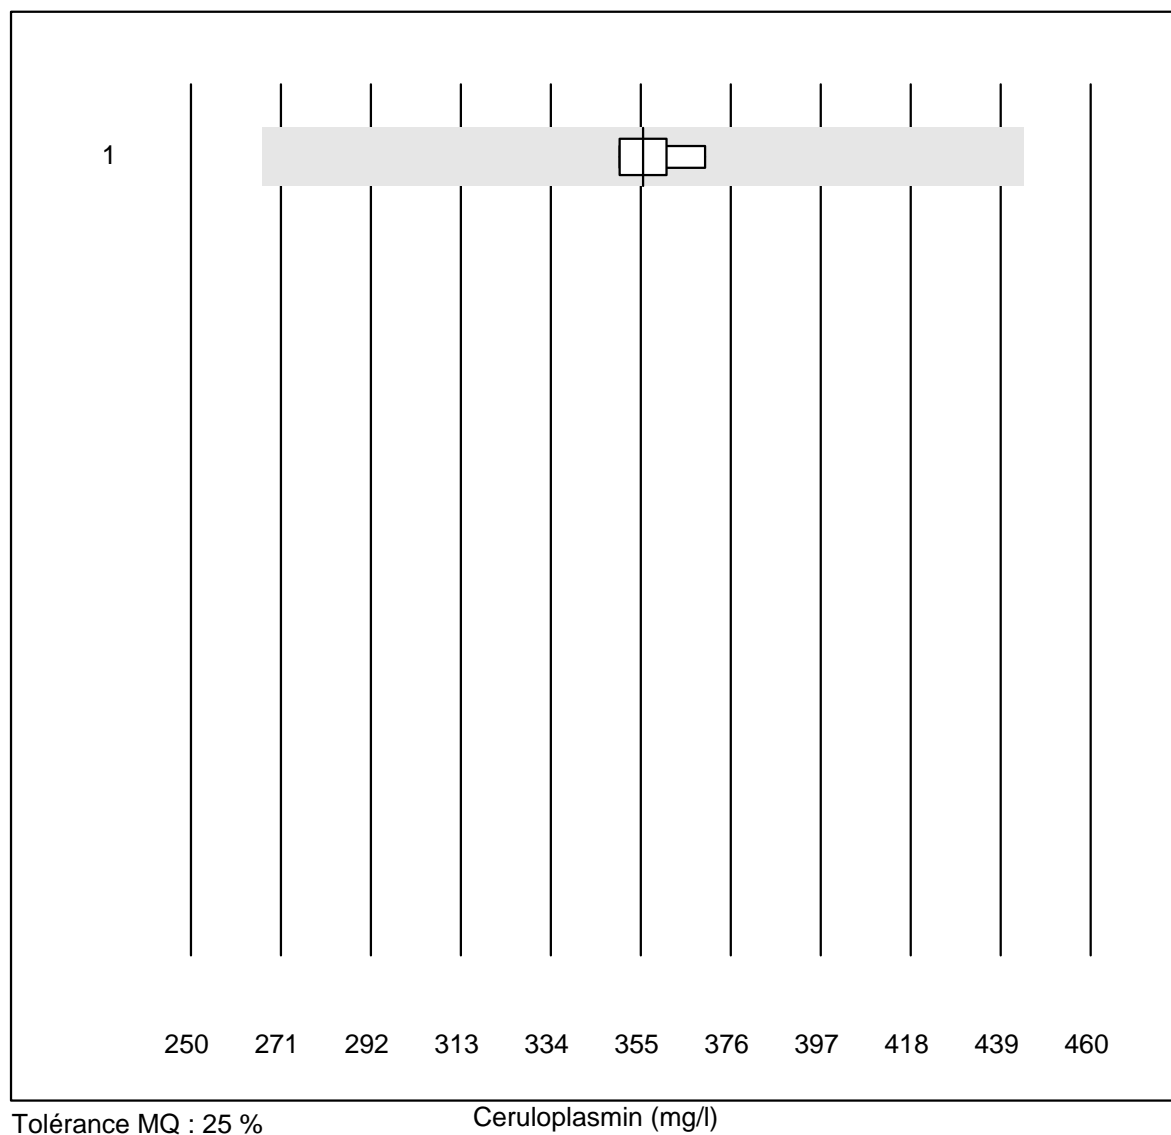


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	355.5	2.7	e

Präalbumin

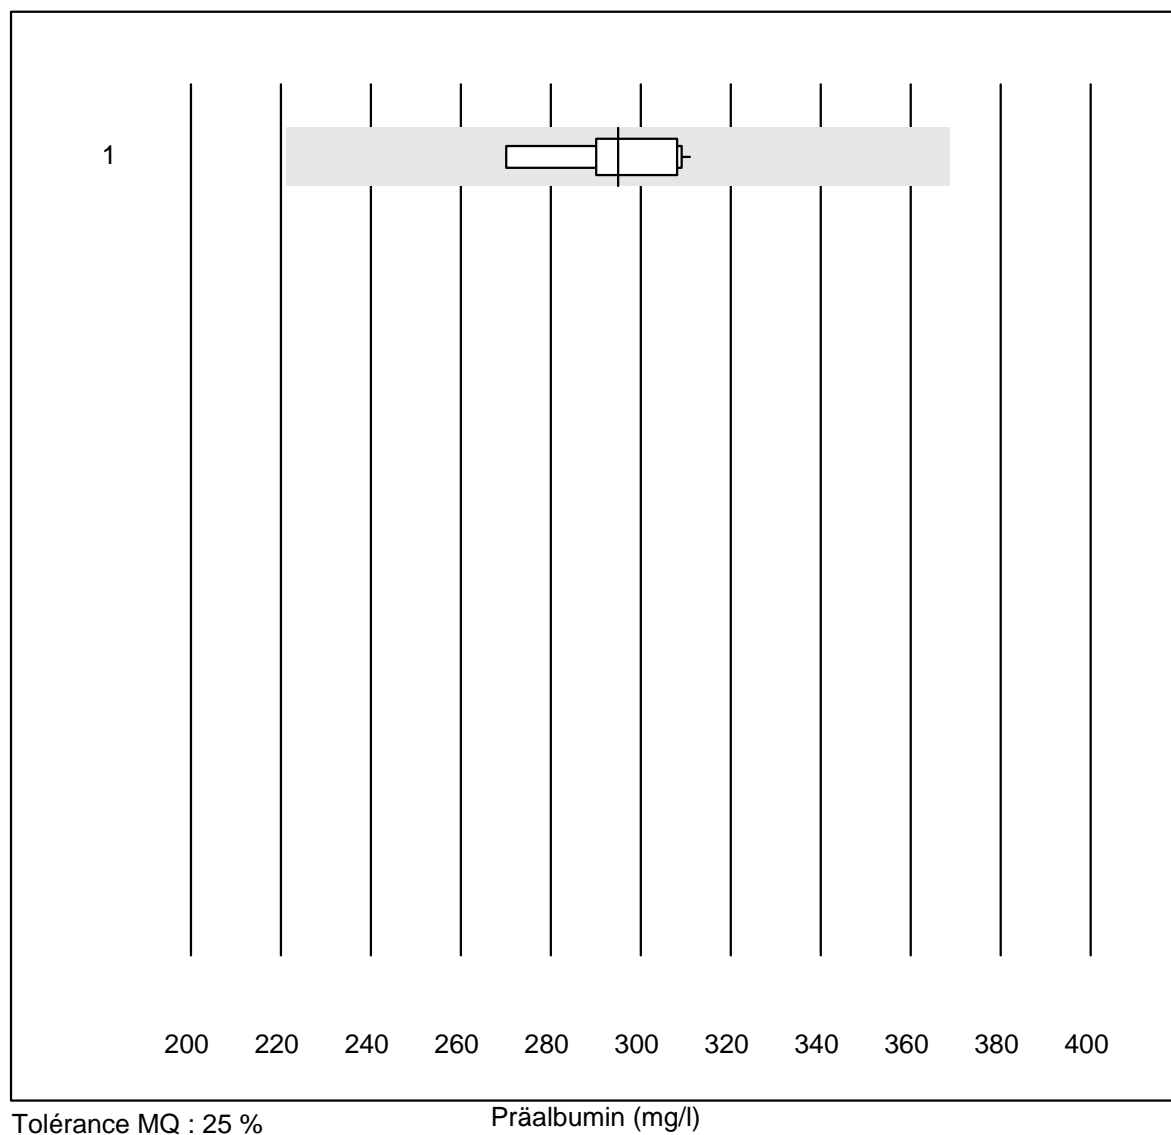

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 toutes les méthodes	10	100.0	0.0	0.0	294.9	4.4	e

Récepteur soluble de la transferrine

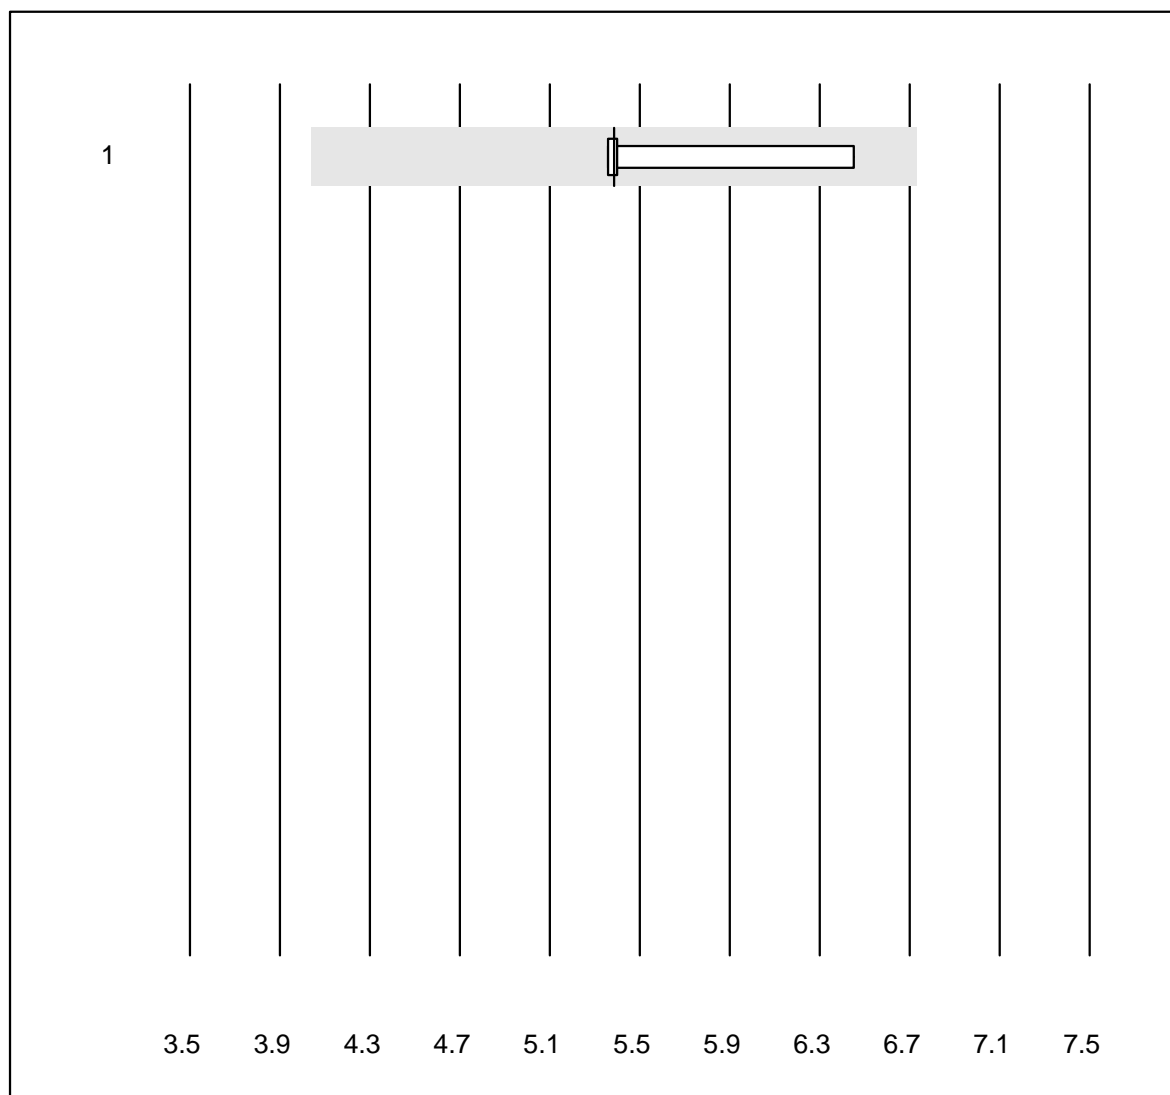


Tolérance MQ : 25 %

Récepteur soluble de la transferrine (mg/l)


No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	5.4	9.5 e*

CRP

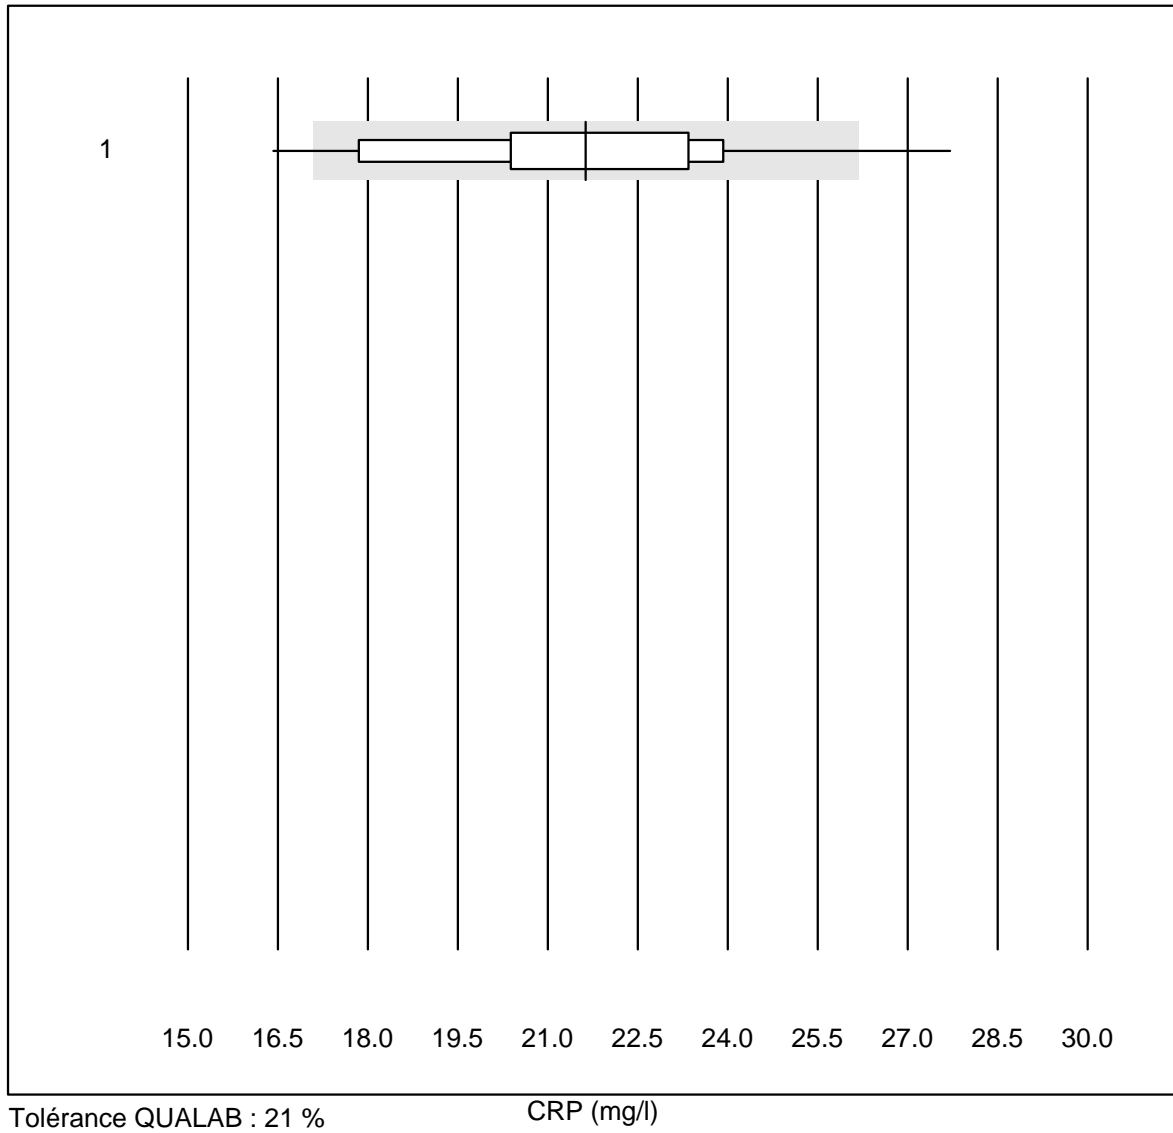


No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 AFIAS	32	87.4	6.3	6.3	21.6	11.1	e

Albumine

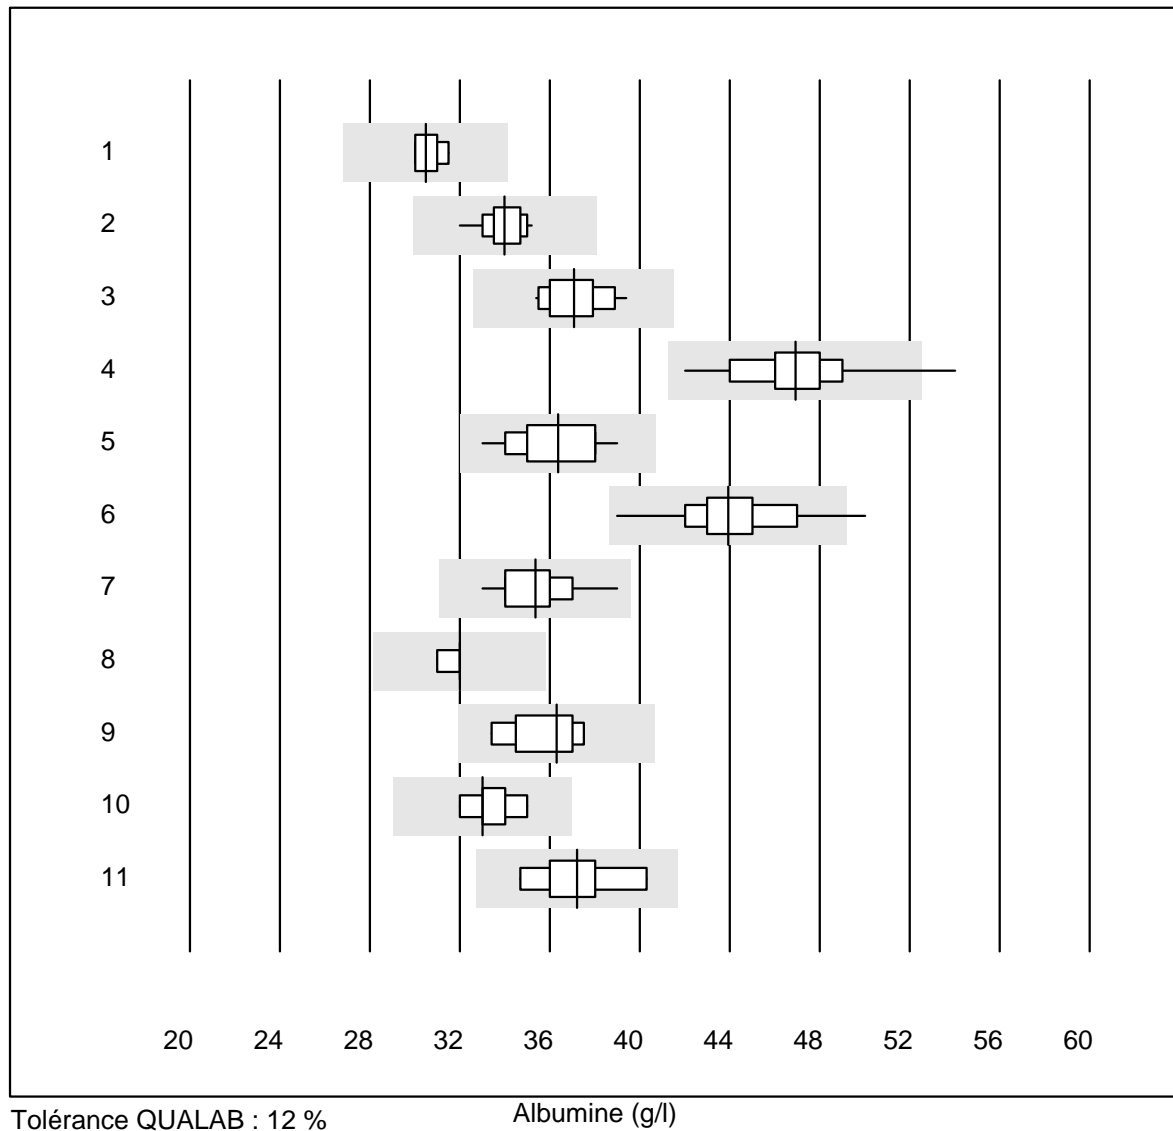

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Dimension	4	100.0	0.0	0.0	31	2.4	e
2 Chimie humide	21	95.2	0.0	4.8	34	2.4	e
3 Cobas	14	100.0	0.0	0.0	37	3.4	e
4 Fuji Dri-Chem	209	98.5	0.5	1.0	47	4.1	e
5 Spotchem/Ready	33	93.9	0.0	6.1	36	4.7	e
6 Spotchem D-Concept	118	99.2	0.8	0.0	44	4.7	e
7 Piccolo	42	100.0	0.0	0.0	35	4.2	e
8 Skyla	8	100.0	0.0	0.0	32	1.1	e
9 Abx Mira	6	100.0	0.0	0.0	36	4.4	e*
10 Hitachi S40/M40	9	100.0	0.0	0.0	33	2.9	e
11 Autolyser/DiaSys	7	100.0	0.0	0.0	37	4.7	e*

Phosphatase alcaline

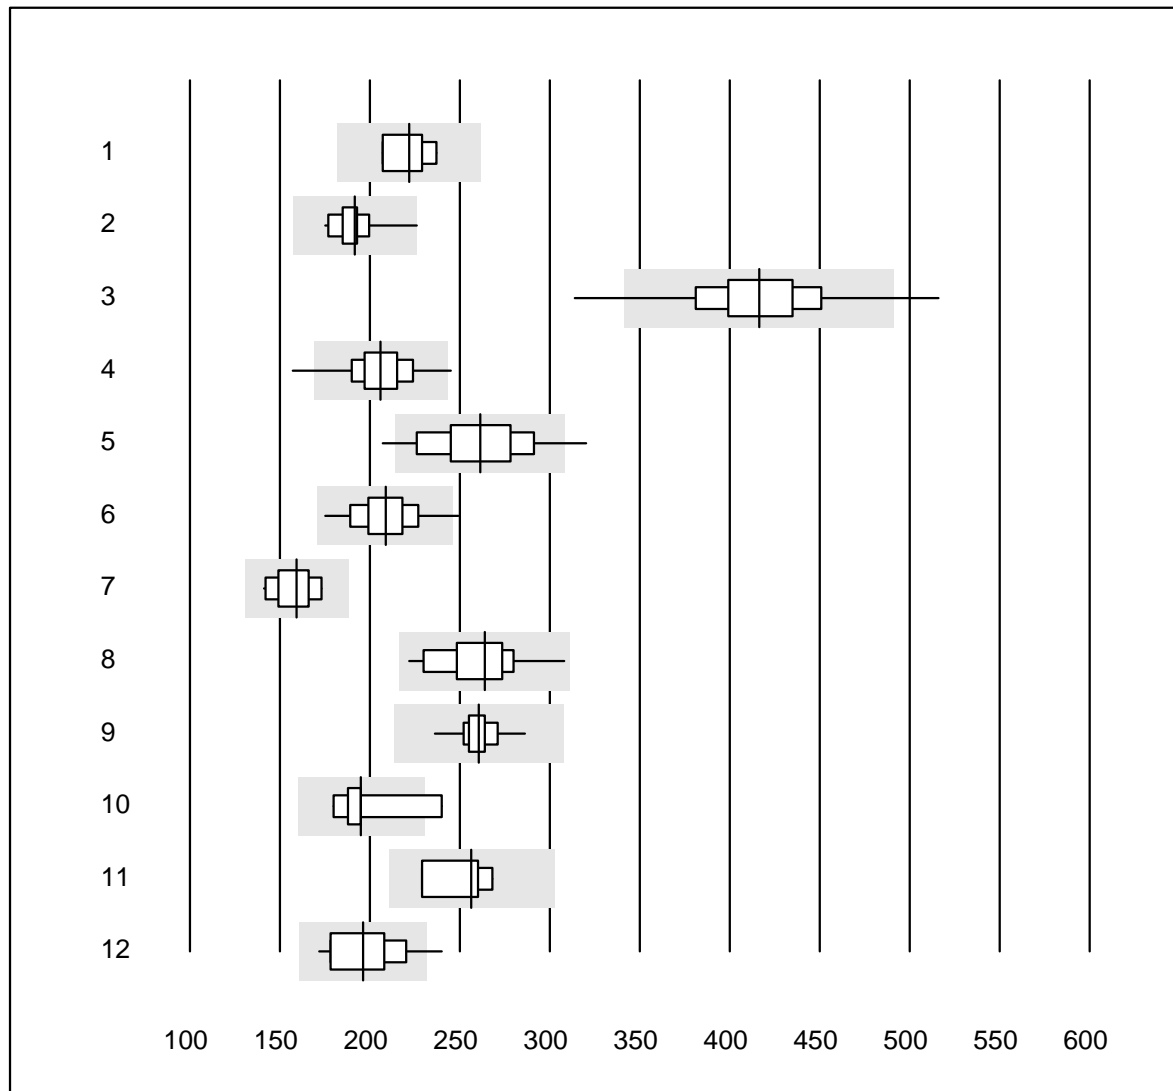


Tolérance QUALAB : 18 %

Phosphatase alcaline (U/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 IFCC	4	100.0	0.0	0.0	222	6.1	e*
2 Cobas	16	93.7	6.3	0.0	191	6.0	e
3 Reflotron	592	96.2	2.4	1.4	416	7.0	e
4 Fuji Dri-Chem	737	99.0	0.5	0.5	206	6.3	e
5 Spotchem/Ready	82	92.7	7.3	0.0	261	9.9	e
6 Spotchem D-Concept	206	98.0	1.0	1.0	209	7.0	e
7 Hitachi S40/M40	17	94.1	0.0	5.9	159	6.3	e
8 Beckman	20	100.0	0.0	0.0	264	7.8	e
9 Piccolo	36	100.0	0.0	0.0	261	3.6	e
10 Abx Mira	9	55.6	11.1	33.3	195	10.6	e*
11 Skyla	4	100.0	0.0	0.0	257	6.7	e*
12 Autolyser/DiaSys	17	82.3	5.9	11.8	196	9.3	e*

Amylase

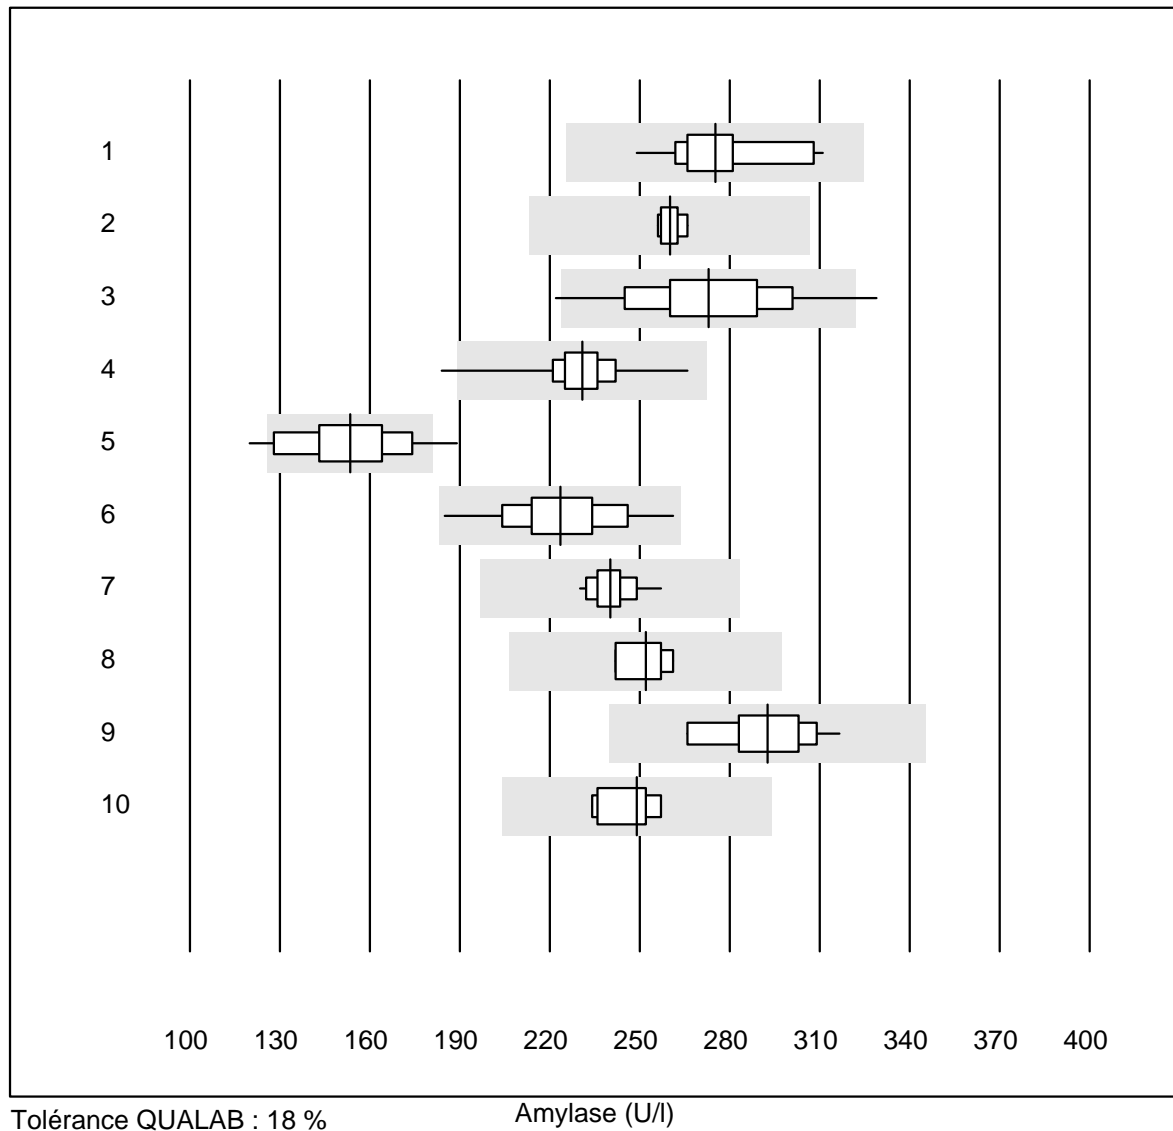

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	IFCC	15	100.0	0.0	0.0	275	6.0	e
2	Cobas	6	100.0	0.0	0.0	260	1.4	e
3	Reflotron	162	97.5	2.5	0.0	273	7.8	e
4	Fuji Dri-Chem	523	99.4	0.2	0.4	231	4.0	e
5	Spotchem/Ready	58	84.5	8.6	6.9	153	10.8	e
6	Spotchem D-Concept	160	99.4	0.0	0.6	224	7.3	e
7	Piccolo	36	100.0	0.0	0.0	240	2.7	e
8	Abx Mira	4	100.0	0.0	0.0	252	3.5	e
9	Hitachi S40/M40	11	90.9	0.0	9.1	293	5.3	e
10	Autolyser/DiaSys	5	100.0	0.0	0.0	249	4.1	e

Amylase pancréatique

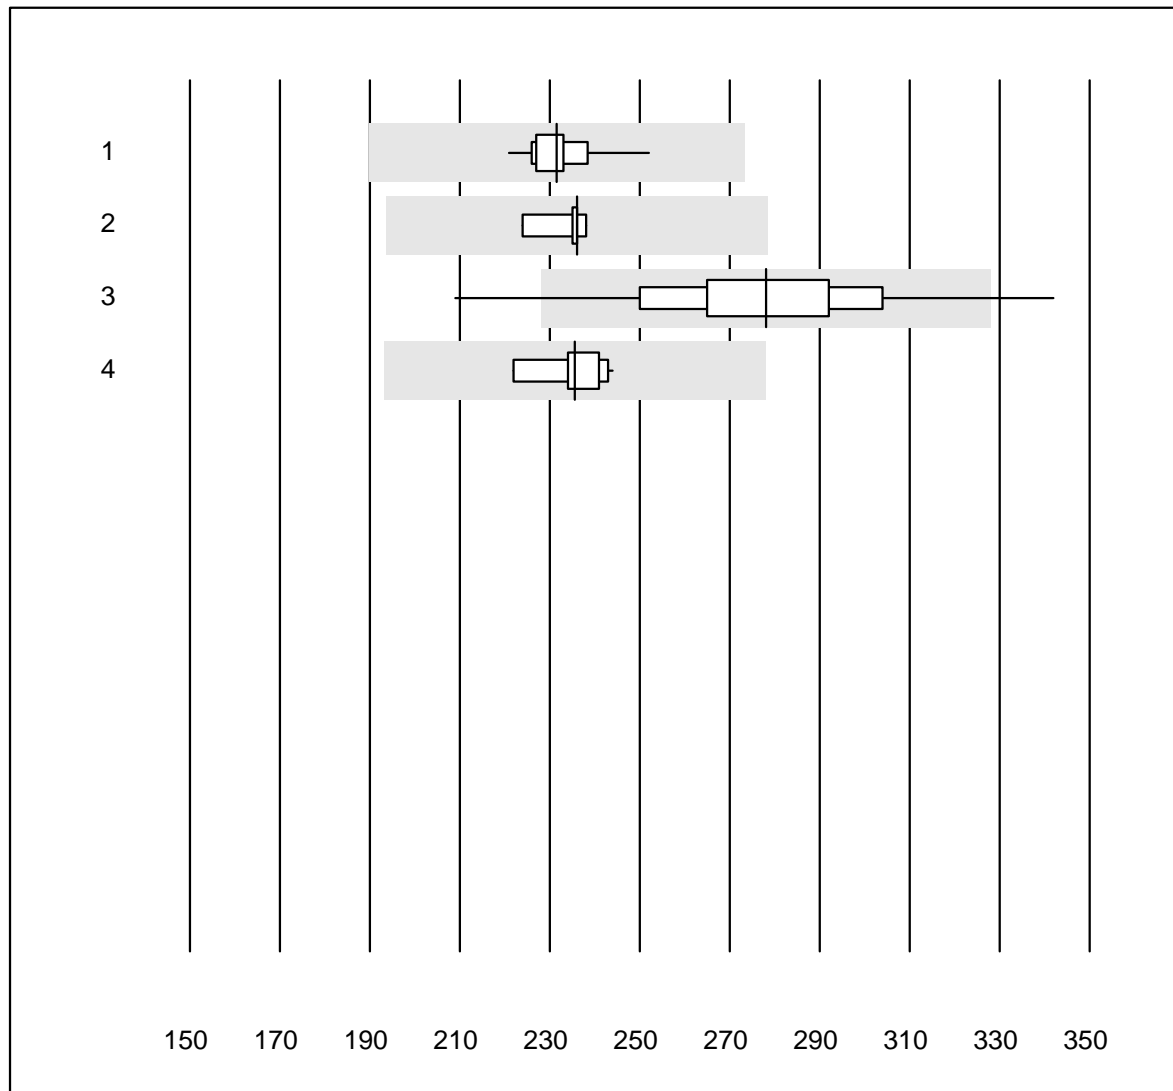


Tolérance QUALAB : 18 %

Amylase pancréatique (U/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 IFCC	21	100.0	0.0	0.0	232	3.0	e
2 Cobas	9	100.0	0.0	0.0	236	1.8	e
3 Reflotron	398	96.2	3.0	0.8	278	7.9	e
4 Autolyser/DiaSys	10	100.0	0.0	0.0	236	2.9	e

Bilirubine totale

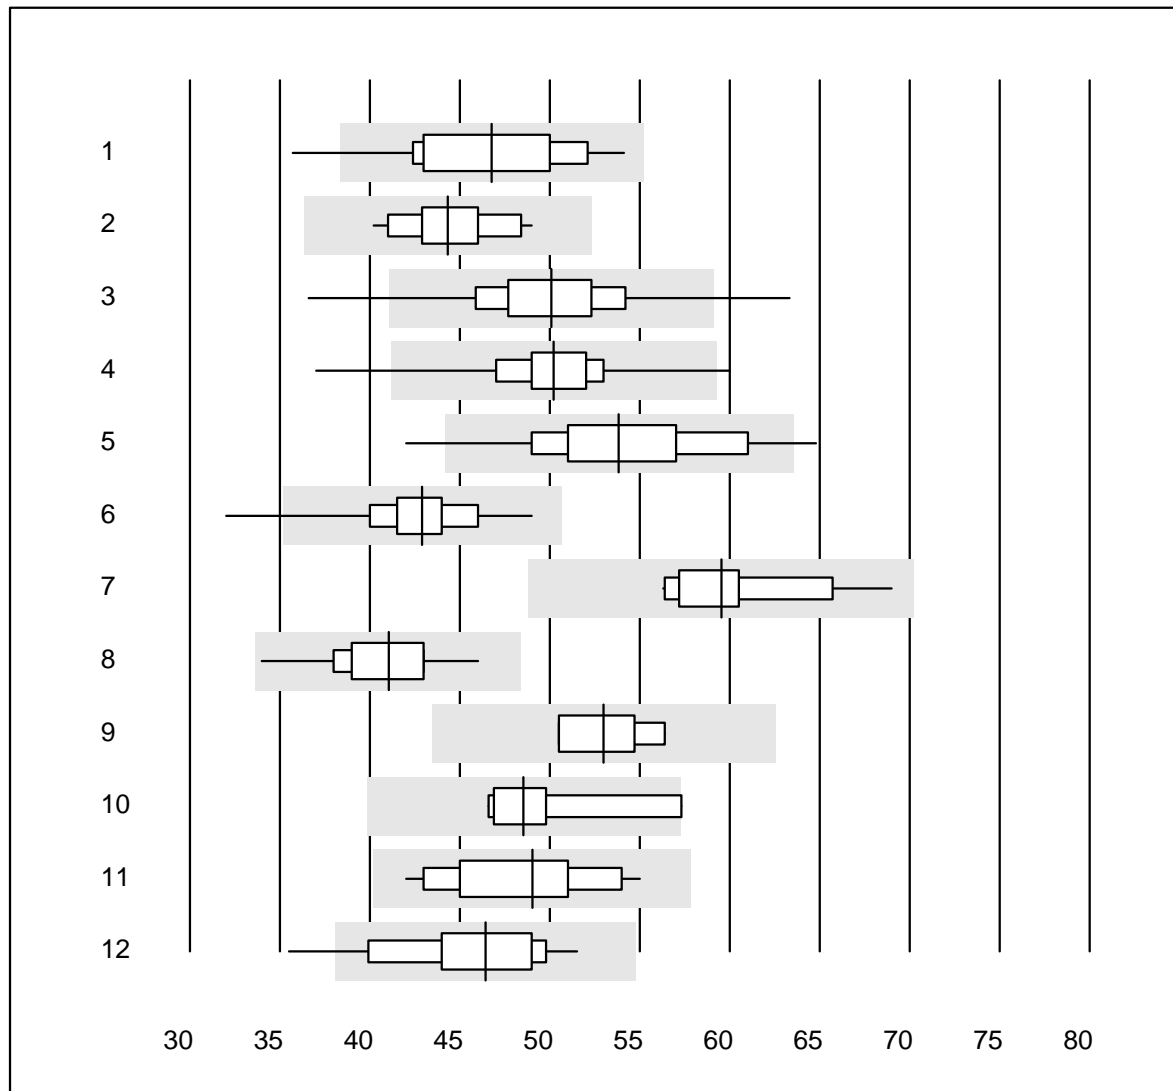


Tolérance QUALAB : 18 %

Bilirubine totale (µmol/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	11	90.9	9.1	0.0	46.8	11.1	e*
2	Cobas	15	100.0	0.0	0.0	44.3	5.6	e
3	Reflotron	435	96.3	2.1	1.6	50.1	7.3	e
4	Fuji Dri-Chem	576	99.2	0.3	0.5	50.2	4.8	e
5	Spotchem/Ready	71	90.1	8.5	1.4	53.8	9.4	e
6	Spotchem D-Concept	167	97.6	1.2	1.2	42.9	6.1	e
7	Beckman	18	100.0	0.0	0.0	59.5	6.0	e
8	Piccolo	41	100.0	0.0	0.0	41.0	5.9	e
9	Skyla	4	100.0	0.0	0.0	53.0	5.2	e*
10	Abx Mira	8	87.5	12.5	0.0	48.6	7.2	e*
11	Hitachi S40/M40	12	100.0	0.0	0.0	49.0	8.4	e*
12	Autolyser/DiaSys	15	93.3	6.7	0.0	46.4	9.1	e*

Bilirubine directe

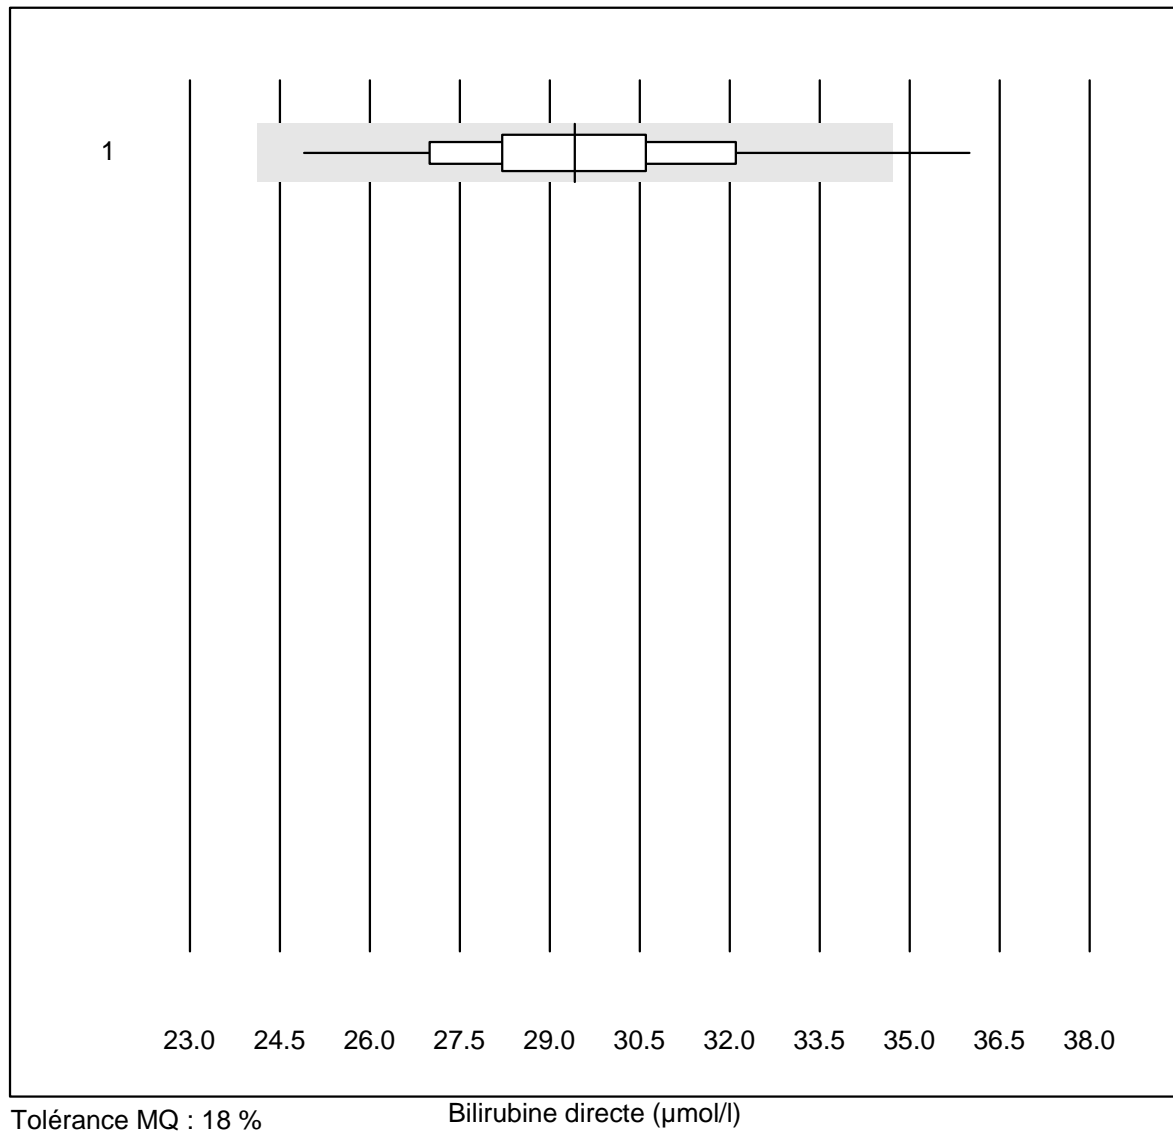

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Fuji Dri-Chem	29	89.7	3.4	6.9	29.4	7.7	e

Calcium

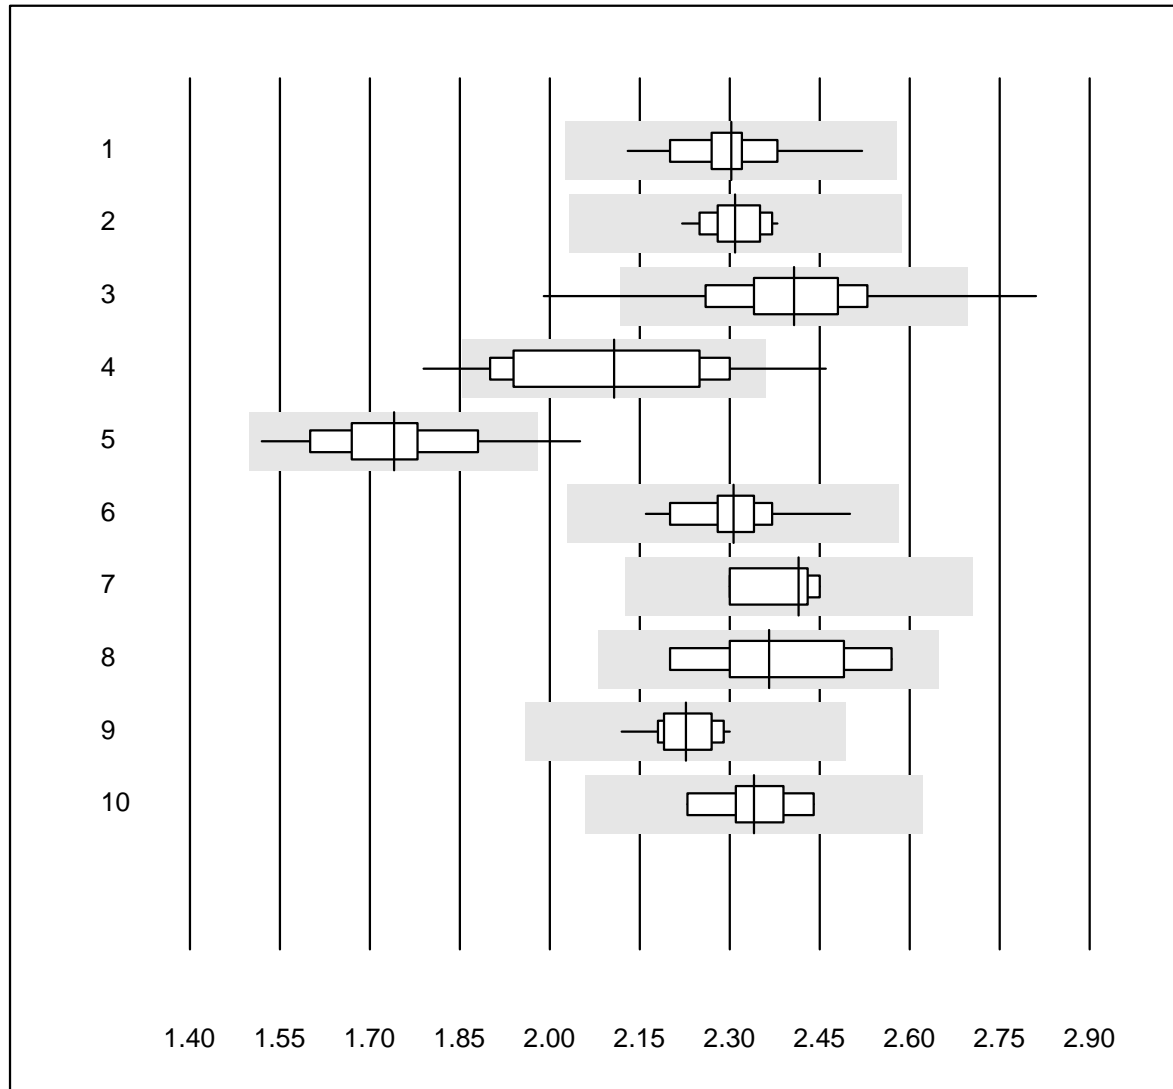


Tolérance QUALAB : 12 %
(< 2.00: +/- 0.24 mmol/l)

Calcium (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	30	100.0	0.0	0.0	2.30	3.3	e
2	Cobas	14	100.0	0.0	0.0	2.31	2.1	e
3	Fuji Dri-Chem	358	97.8	1.1	1.1	2.41	4.7	e
4	Spotchem/Ready	26	77.0	11.5	11.5	2.11	8.4	e*
5	Spotchem D-Concept	81	95.1	3.7	1.2	1.74	6.0	e
6	Piccolo	39	100.0	0.0	0.0	2.31	2.8	e
7	Skyla	4	100.0	0.0	0.0	2.42	2.8	e
8	Abx Mira	6	100.0	0.0	0.0	2.37	5.8	e*
9	Hitachi S40/M40	11	100.0	0.0	0.0	2.23	2.4	e
10	Autolyser/DiaSys	9	100.0	0.0	0.0	2.34	3.1	e

Calcium ISE

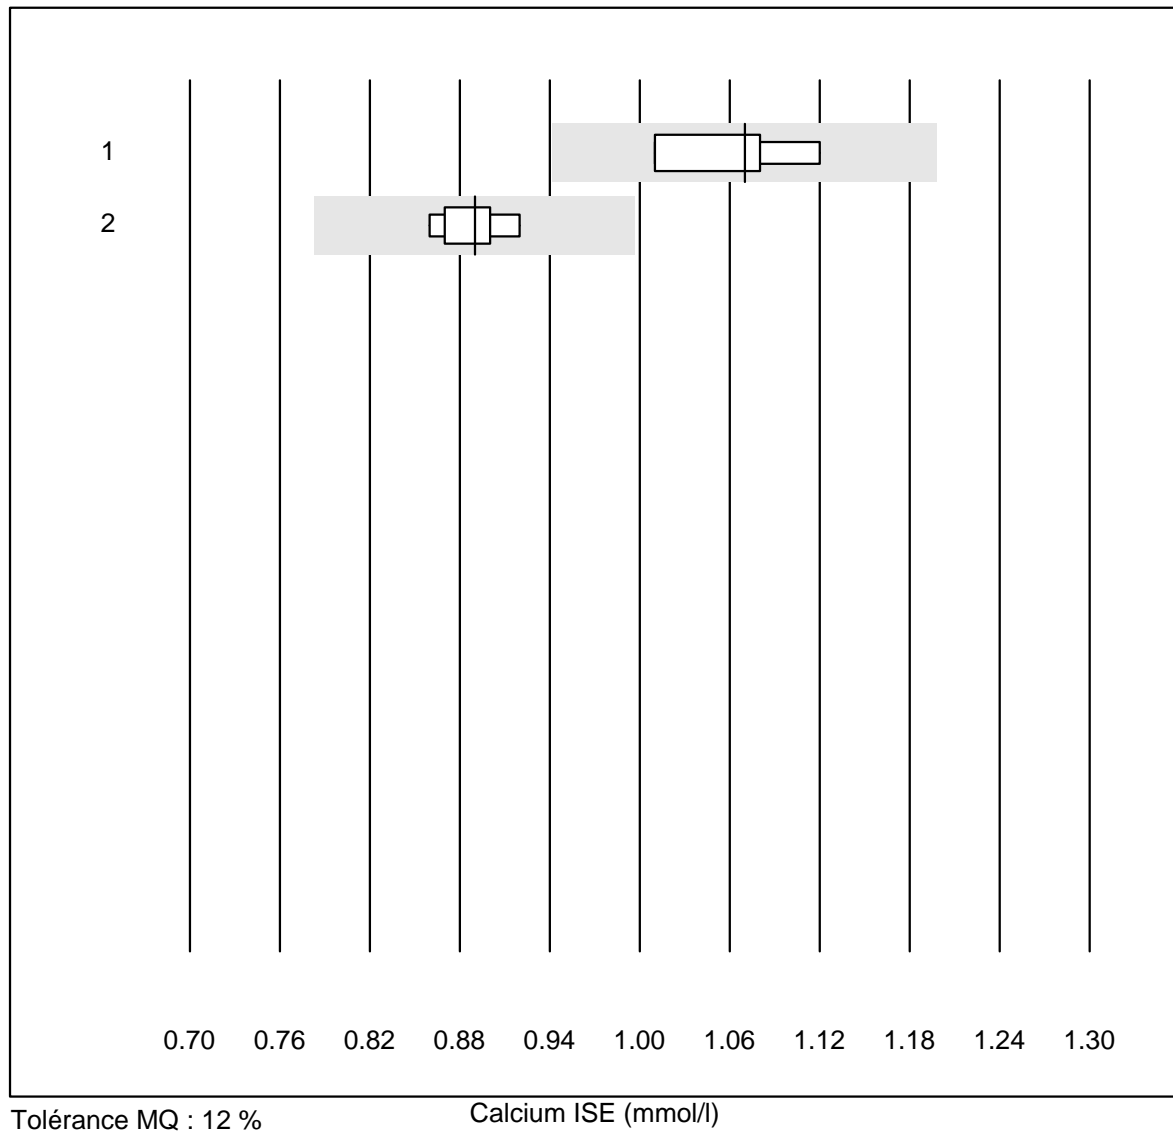


Tolérance MQ : 12 %

Calcium ISE (mmol/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ISE direct	4	100.0	0.0	0.0	1.07	4.3	e*
2 iStat Chem8	8	100.0	0.0	0.0	0.89	2.1	e

Chlorures

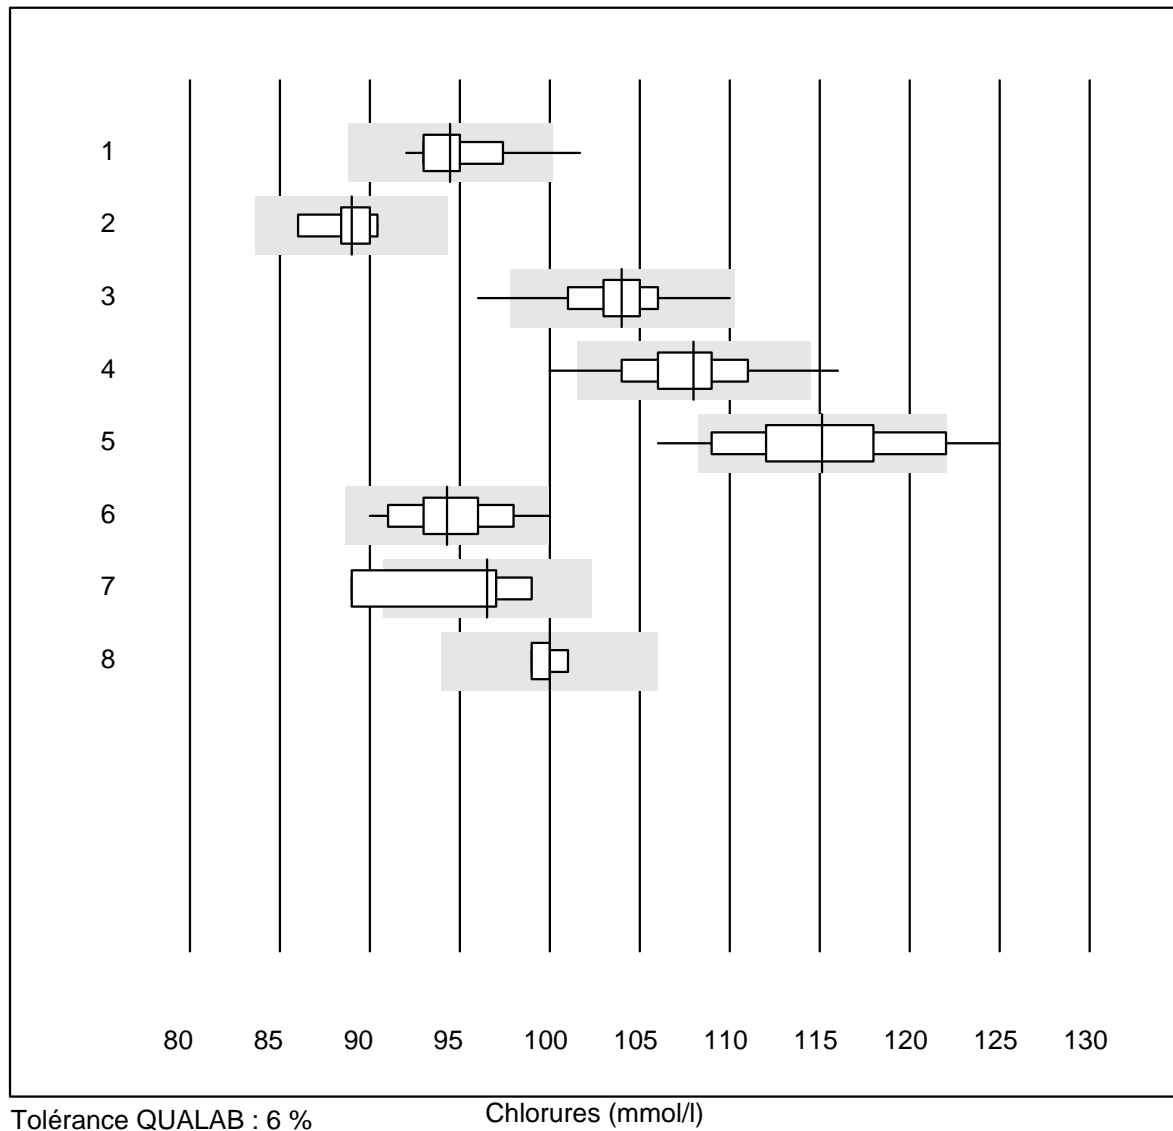

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	ISE	27	92.6	3.7	3.7	94	2.2	e
2	Cobas	7	100.0	0.0	0.0	89	1.6	e
3	Fuji Dri-Chem	679	96.2	1.6	2.2	104	2.1	e
4	Spotchem D-Concept	187	94.7	3.7	1.6	108	2.7	e
5	Spotchem EL-SE 1520	98	81.7	12.2	6.1	115	4.0	e
6	Piccolo	18	94.4	5.6	0.0	94	2.8	e
7	Skylla	4	75.0	25.0	0.0	97	4.6	e*
8	iStat Chem8	8	100.0	0.0	0.0	100	0.6	e

Cholestérol

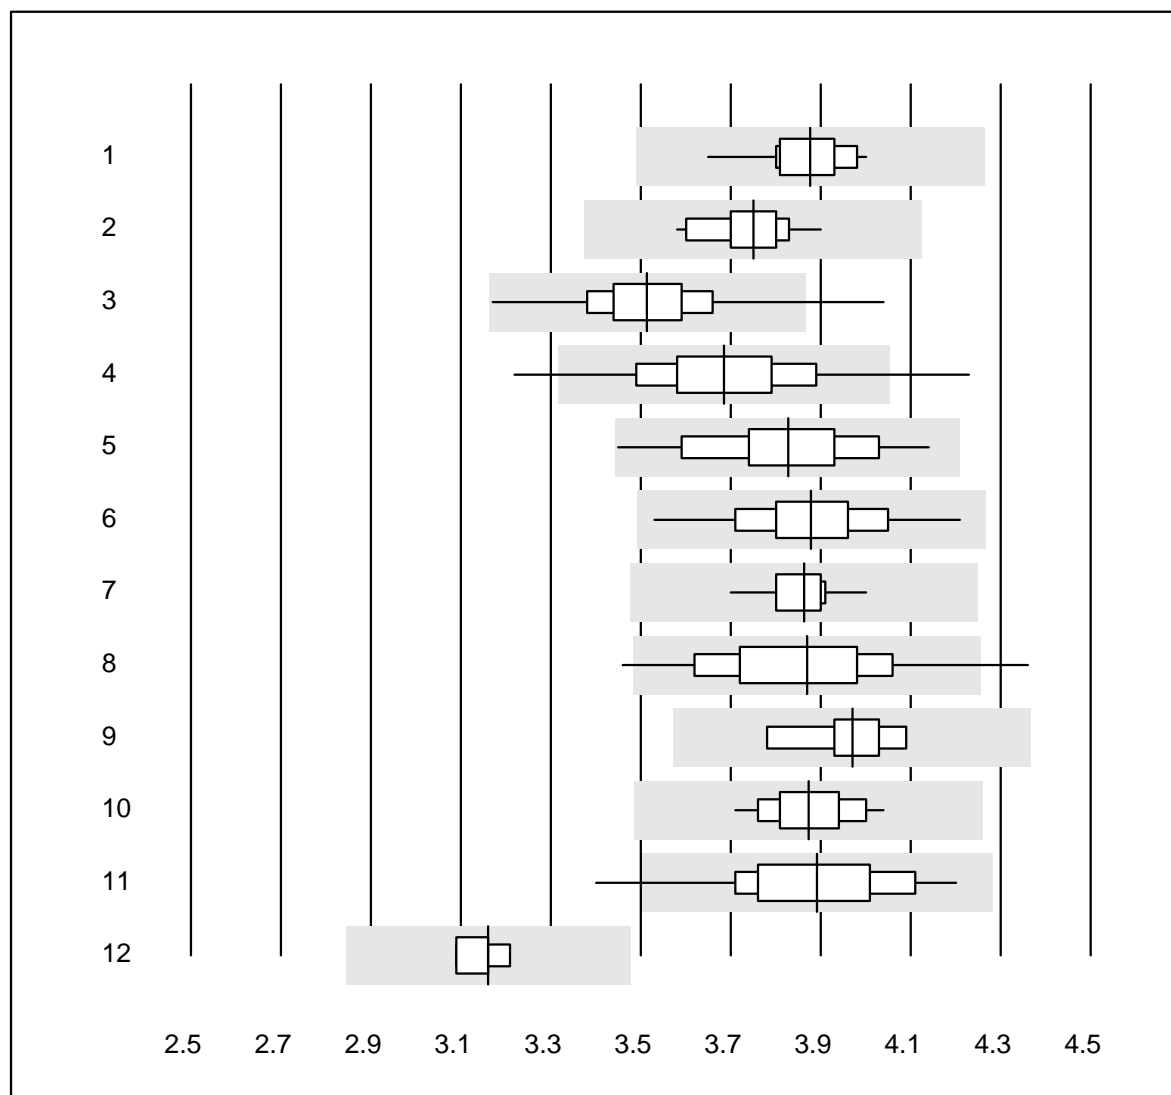


Tolérance QUALAB : 10 %

Cholestérol (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	27	100.0	0.0	0.0	3.88	2.2	e
2	Cobas	16	100.0	0.0	0.0	3.75	2.2	e
3	Reflotron	600	98.5	0.7	0.8	3.51	3.4	e
4	Fuji Dri-Chem	745	97.6	1.9	0.5	3.68	4.3	e
5	Spotchem/Ready	110	97.3	0.0	2.7	3.83	4.2	e
6	Spotchem D-Concept	211	98.6	0.0	1.4	3.88	3.2	e
7	Piccolo	21	100.0	0.0	0.0	3.86	1.9	e
8	Cholestech LDX	153	95.4	2.0	2.6	3.87	4.6	e
9	Abx Mira	9	100.0	0.0	0.0	3.97	2.4	e
10	Hitachi S40/M40	15	93.3	0.0	6.7	3.87	2.4	e
11	Autolyser/DiaSys	16	93.7	6.3	0.0	3.89	4.9	e*
12	Autres méthodes	5	80.0	0.0	20.0	3.16	1.6	e

Cholestérol HDL

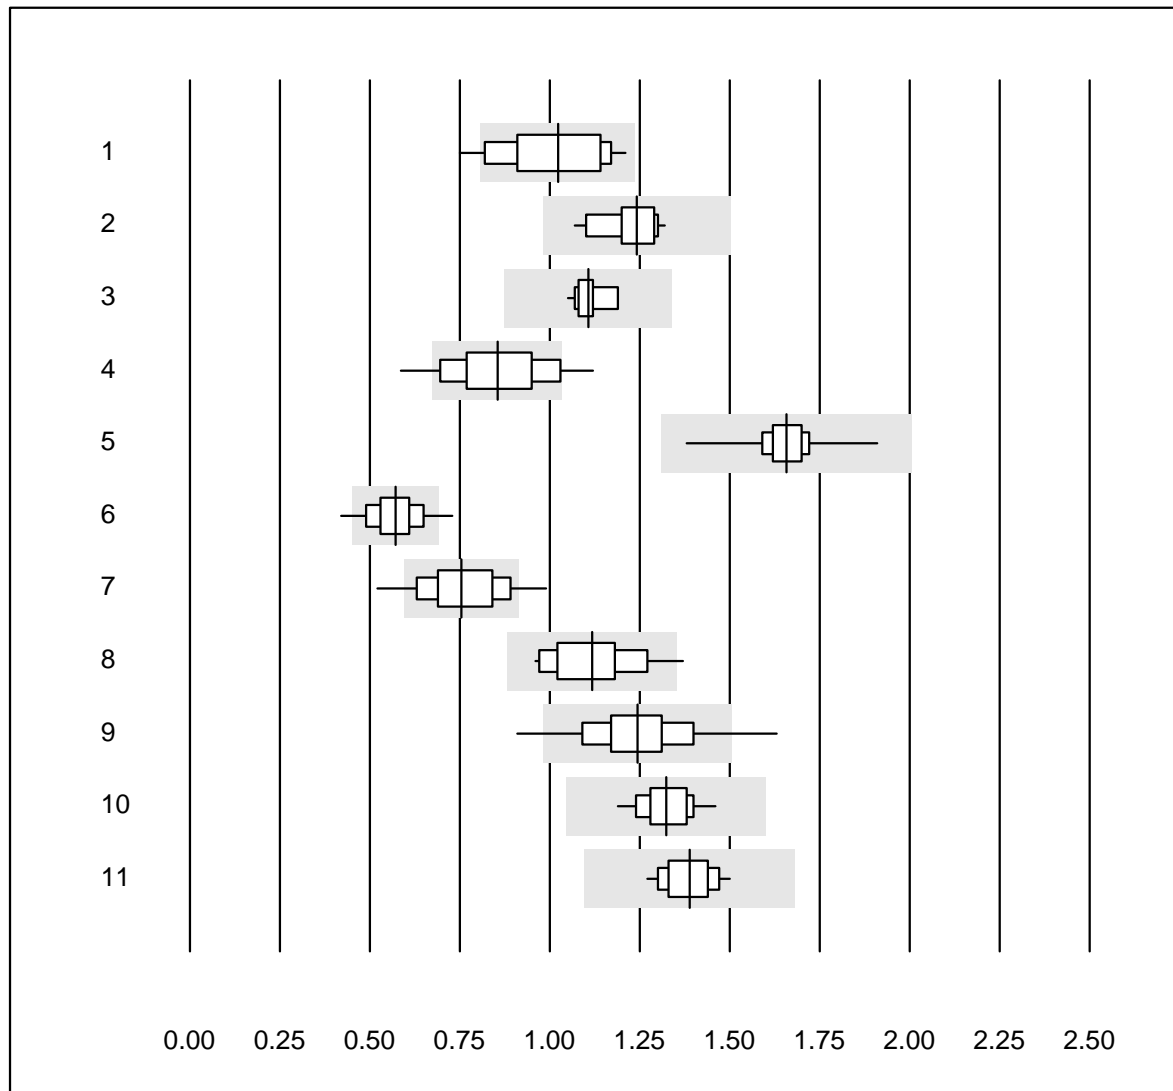


Tolérance QUALAB : 21 %

Cholestérol HDL (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Pentra/Selectra	13	92.3	7.7	0.0	1.02	14.0	e*
2	humide, direct	17	94.1	0.0	5.9	1.24	6.0	e
3	Cobas	14	92.9	0.0	7.1	1.11	3.9	e
4	Reflotron	448	74.7	15.0	10.3	0.85	14.4	e
5	Fuji Dri-Chem	712	99.7	0.0	0.3	1.66	3.4	e
6	Spotchem/Ready	99	93.0	3.0	4.0	0.57	10.1	e
7	Spotchem D-Concept	208	83.7	12.0	4.3	0.76	13.5	e
8	Piccolo	20	90.0	5.0	5.0	1.12	10.2	e
9	Cholestech LDX	151	90.8	4.6	4.6	1.24	10.0	e
10	Hitachi S40/M40	14	100.0	0.0	0.0	1.32	5.4	e
11	Autolyser/DiaSys	16	100.0	0.0	0.0	1.39	4.9	e

Créatine-kinase

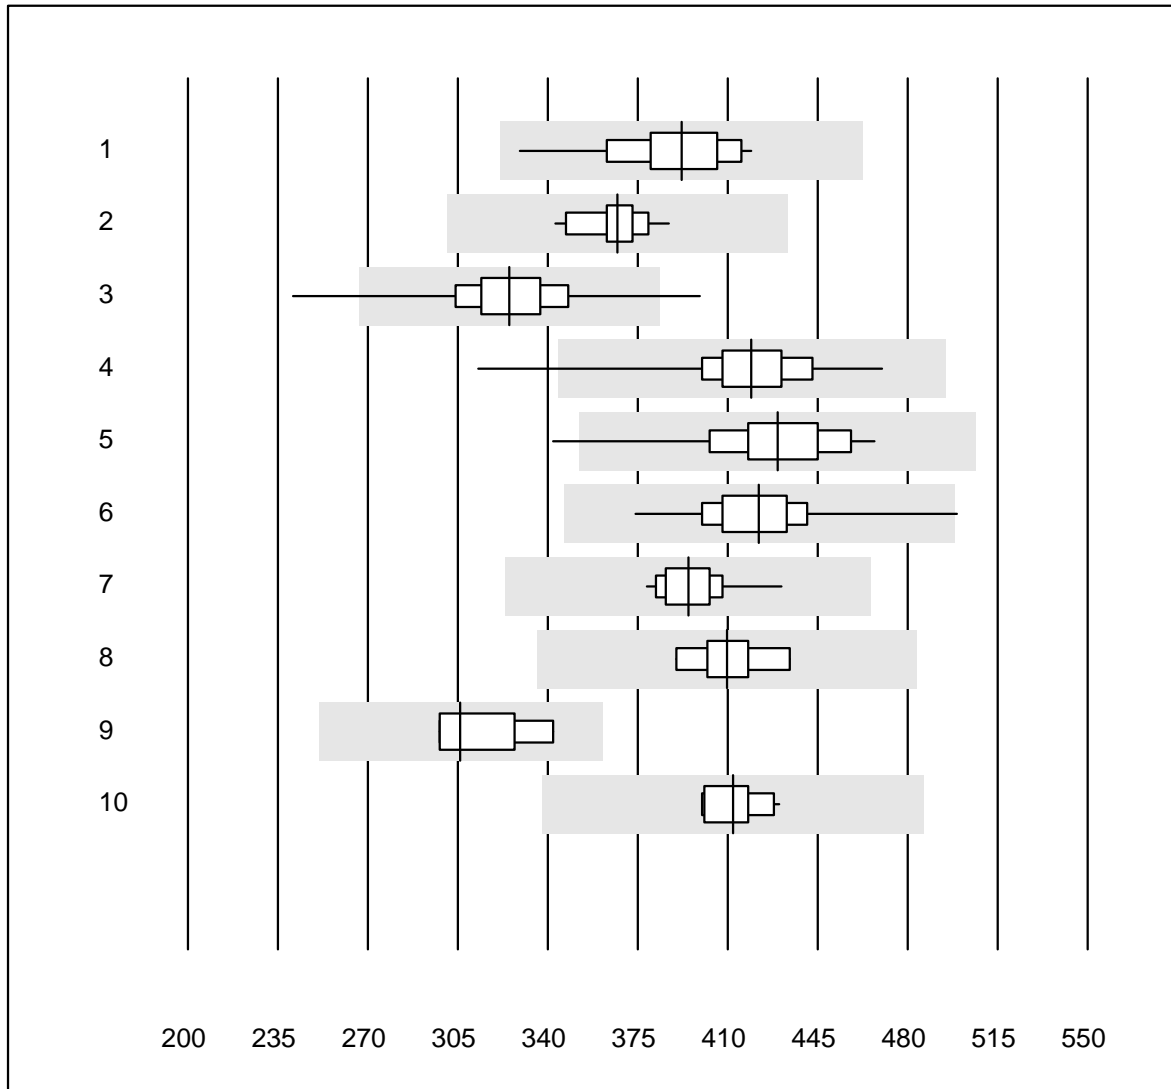


Tolérance QUALAB : 18 %

Créatine-kinase (U/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 IFCC	28	100.0	0.0	0.0	392	5.3	e
2 Cobas	13	100.0	0.0	0.0	367	3.4	e
3 Reflotron	380	96.1	1.3	2.6	325	6.1	e
4 Fuji Dri-Chem	475	97.9	0.8	1.3	419	4.8	e
5 Spotchem/Ready	48	95.8	2.1	2.1	429	5.7	e
6 Spotchem D-Concept	136	97.8	0.7	1.5	422	4.8	e
7 Piccolo	18	100.0	0.0	0.0	395	3.3	e
8 Abx Mira	6	100.0	0.0	0.0	410	3.7	e
9 Hitachi S40/M40	9	77.8	0.0	22.2	306	5.1	e
10 Autolyser/DiaSys	13	100.0	0.0	0.0	412	2.6	e

LDL Cholesterin

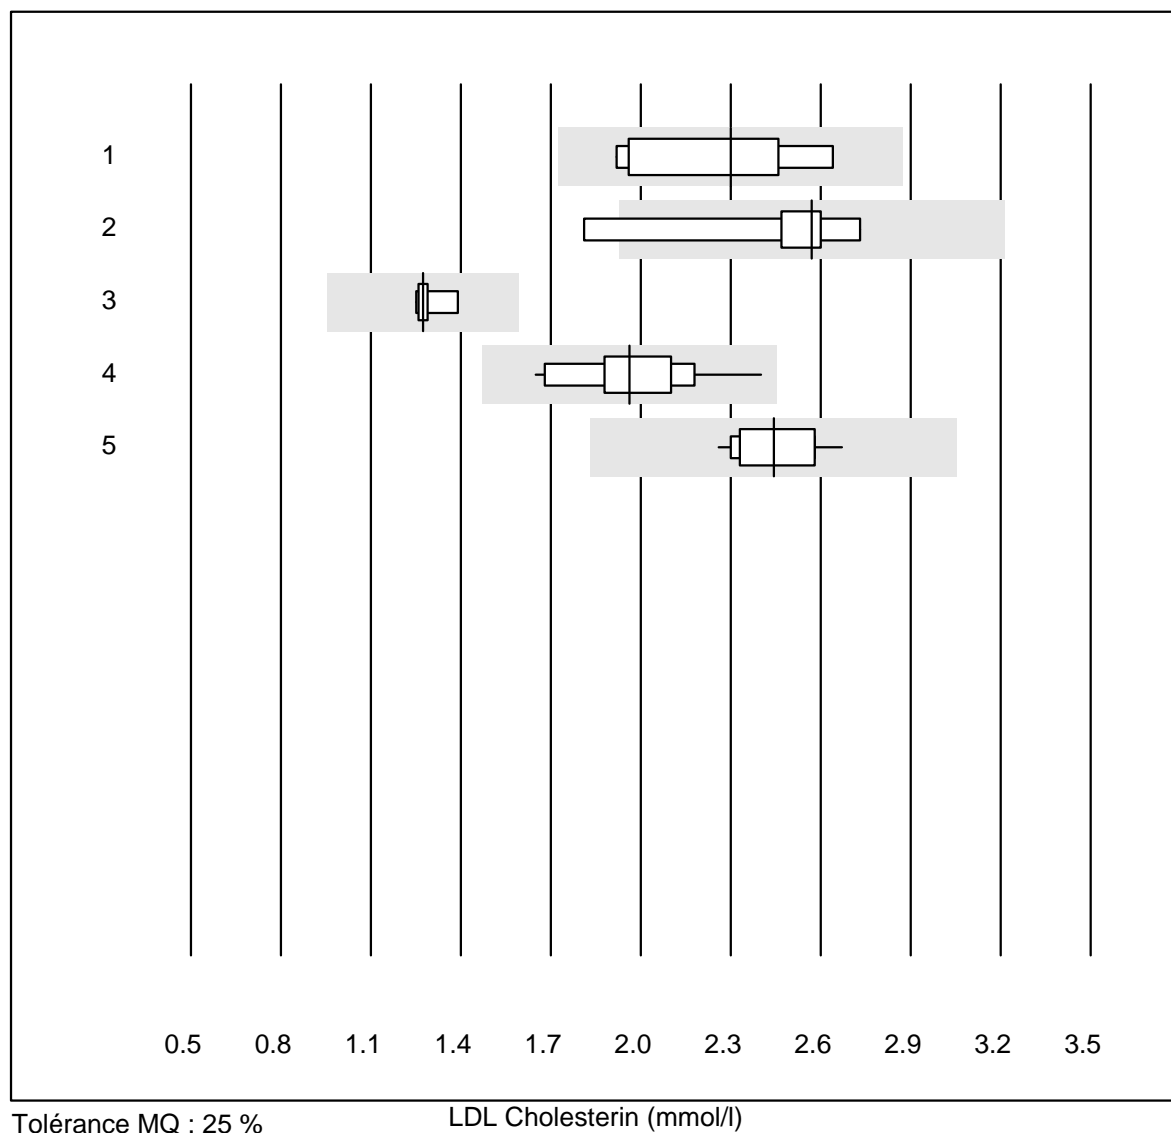


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	5	100.0	0.0	0.0	2.3	13.9	e*
2	Roche, Cobas	7	85.7	14.3	0.0	2.6	12.2	e*
3	Hitachi S40/M40	8	100.0	0.0	0.0	1.3	4.2	e
4	Autolyser/DiaSys	13	100.0	0.0	0.0	2.0	10.9	e*
5	Beckman	11	100.0	0.0	0.0	2.4	5.5	e

Fer

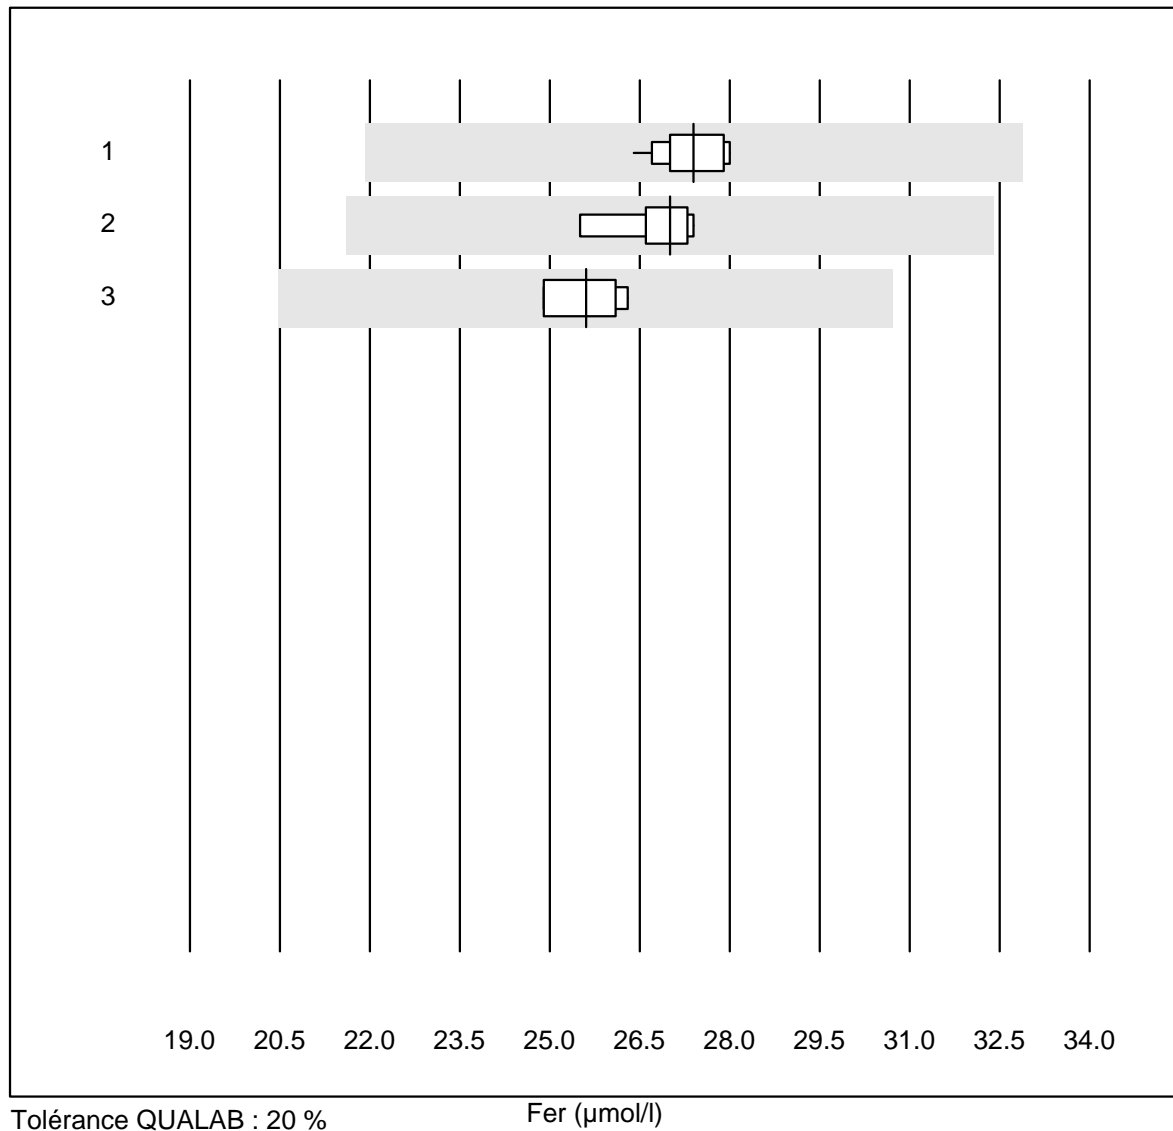


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	15	100.0	0.0	0.0	27	1.7	e
2	Cobas	8	100.0	0.0	0.0	27	2.3	e
3	Abx Mira	5	80.0	0.0	20.0	26	2.4	e

Gamma-GT

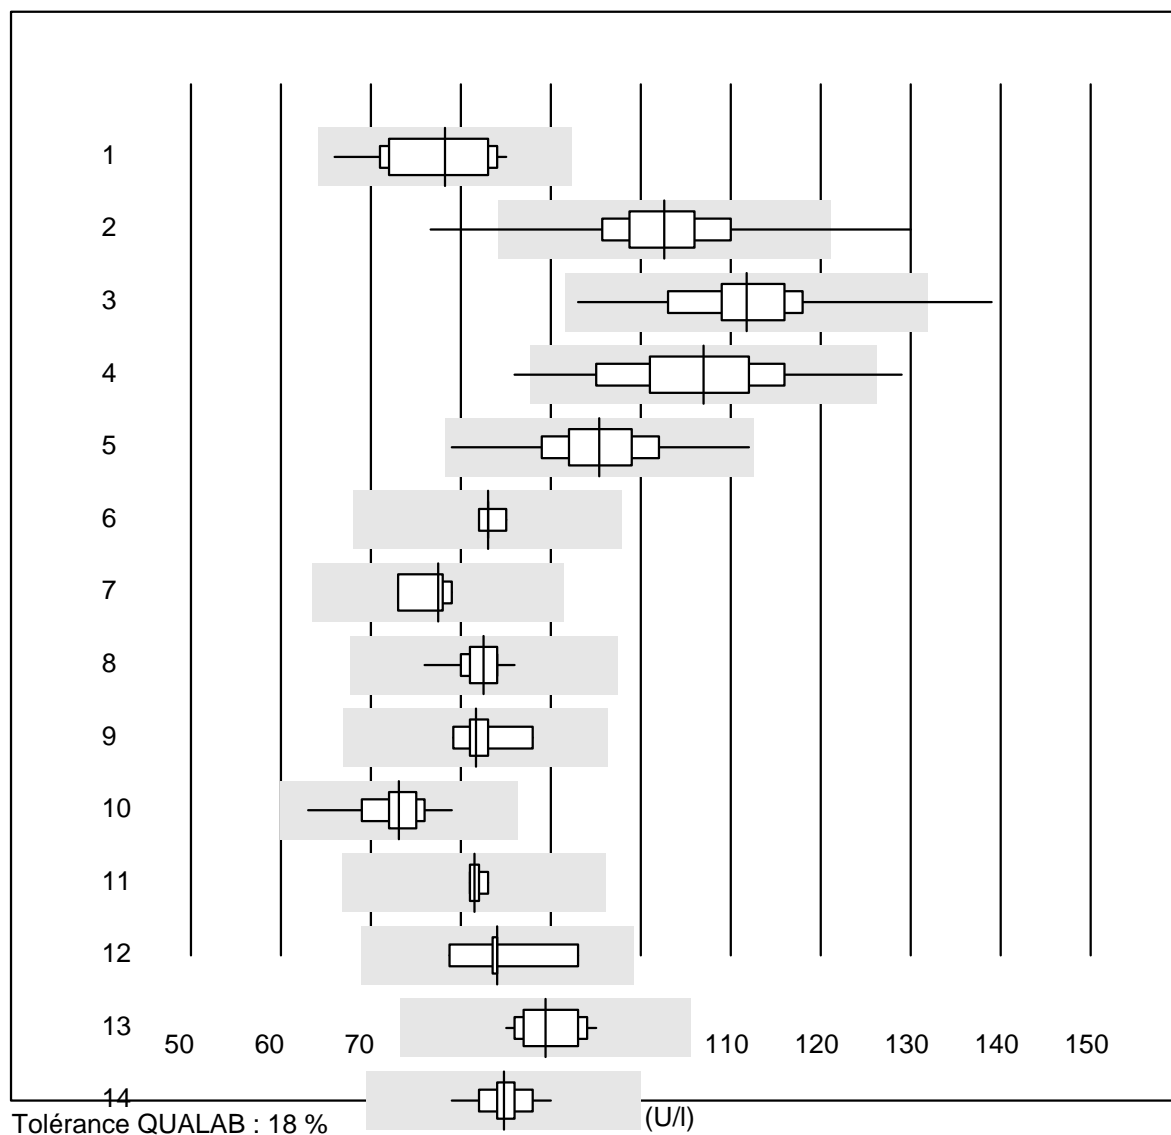

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas	16	100.0	0.0	0.0	78	7.9	e
2	Reflotron	765	98.3	0.9	0.8	103	5.9	e
3	Fuji Dri-Chem	817	99.2	0.1	0.7	112	5.0	e
4	Spotchem/Ready	116	98.3	1.7	0.0	107	7.8	e
5	Spotchem D-Concept	231	100.0	0.0	0.0	95	5.8	e
6	Selectra/Biolis	6	100.0	0.0	0.0	83	1.2	e
7	Architect	4	100.0	0.0	0.0	78	3.4	e
8	Dimension	13	100.0	0.0	0.0	83	3.1	e
9	IFCC Beckmann	8	100.0	0.0	0.0	82	3.2	e
10	Piccolo	34	100.0	0.0	0.0	73	4.6	e
11	Skyla	4	100.0	0.0	0.0	82	1.2	e
12	Abx Mira	5	100.0	0.0	0.0	84	6.1	e*
13	Hitachi S40/M40	17	100.0	0.0	0.0	89	3.7	e
14	Autolyser/DiaSys	17	100.0	0.0	0.0	85	3.0	e

Glucose

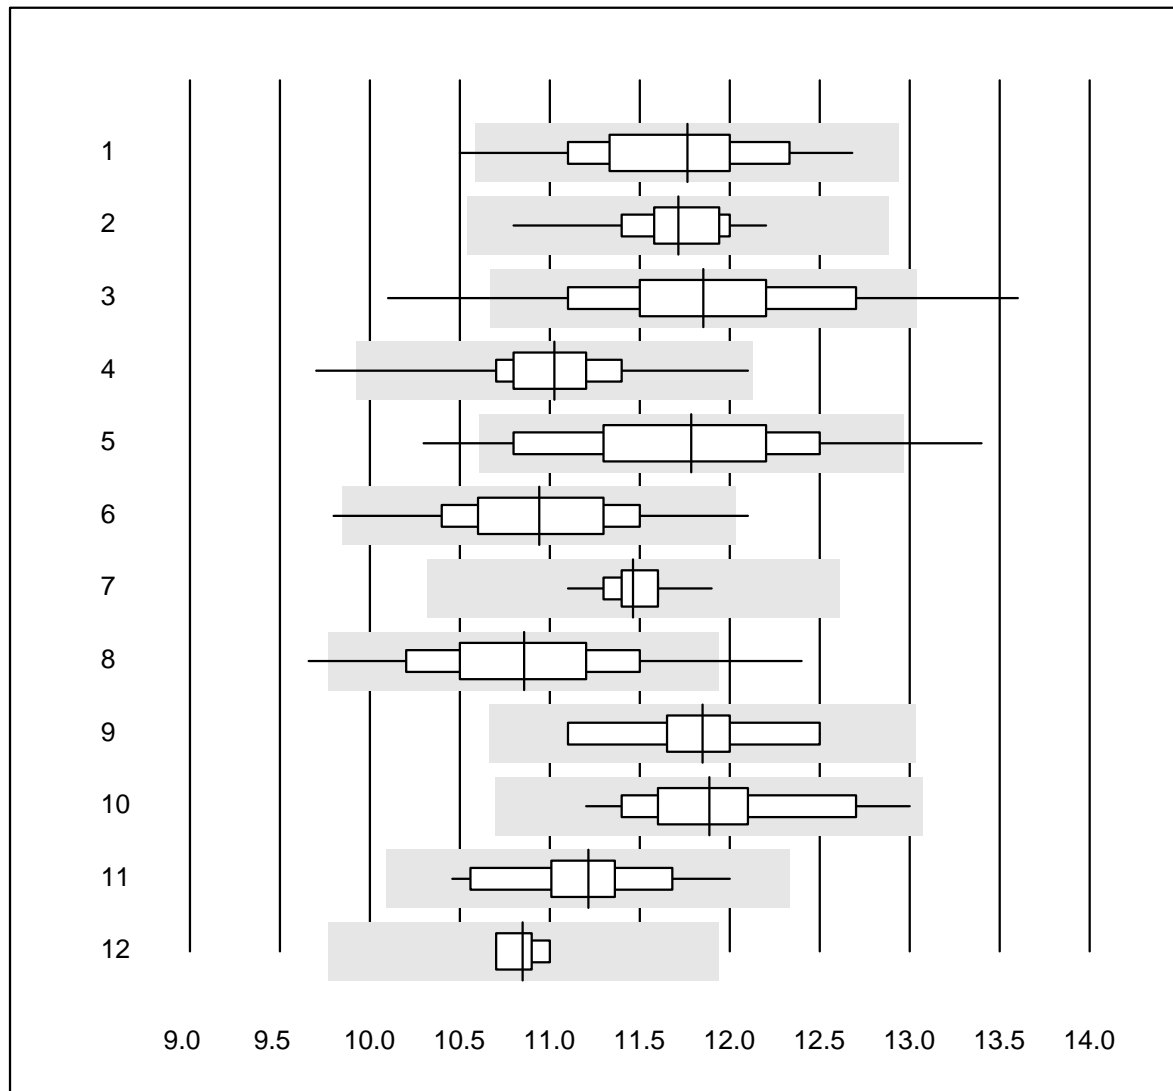


Tolérance QUALAB : 10 %

Glucose (mmol/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	38	94.8	2.6	2.6	11.8	4.1	e
2	Cobas	14	100.0	0.0	0.0	11.7	2.9	e
3	Reflotron	762	92.0	6.2	1.8	11.9	5.2	e
4	Fuji Dri-Chem	770	99.9	0.1	0.0	11.0	2.4	e
5	Spotchem/Ready	103	90.3	6.8	2.9	11.8	5.3	e
6	Spotchem D-Concept	217	99.1	0.9	0.0	10.9	4.0	e
7	Piccolo	47	100.0	0.0	0.0	11.5	1.3	e
8	Cholestech LDX	125	92.0	6.4	1.6	10.9	5.0	e
9	Abx Mira	9	88.9	0.0	11.1	11.9	3.3	e
10	Hitachi S40/M40	18	94.4	0.0	5.6	11.9	3.8	e
11	Autolyser/DiaSys	17	100.0	0.0	0.0	11.2	3.4	e
12	iStat Chem8	8	100.0	0.0	0.0	10.9	1.1	e

Glucose

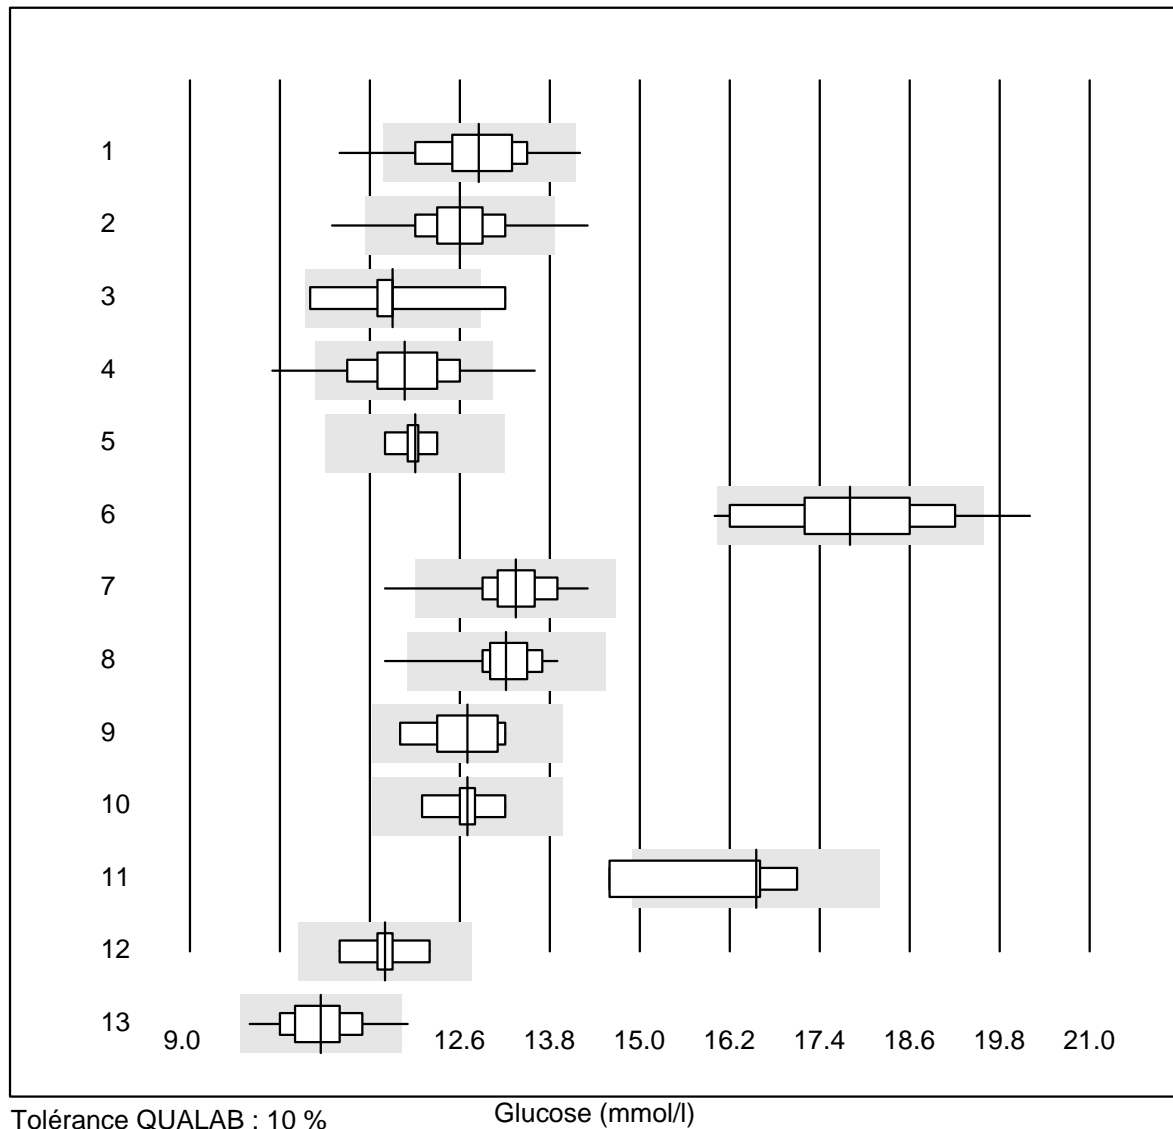


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Accu-Chek Aviva	352	92.4	4.8	2.8	12.9	4.8	e
2	Accu-Chek Inform 2	351	97.1	2.0	0.9	12.6	3.8	e
3	Accu-Chek Mobile	5	80.0	20.0	0.0	11.7	8.0	e*
4	Contour XT	1119	93.8	5.4	0.8	11.9	5.0	e
5	Skylla	5	100.0	0.0	0.0	12.0	2.1	e
6	Glucocard	19	84.2	10.5	5.3	17.8	6.2	e*
7	Hemocue 201+ P-equiv	98	95.9	3.1	1.0	13.3	3.4	e
8	Hemocue 201RT P-equiv	71	97.2	1.4	1.4	13.2	2.7	e
9	FreeStyle Precision	7	100.0	0.0	0.0	12.7	4.0	e*
10	Freestyle Freedom li	7	100.0	0.0	0.0	12.7	2.6	e
11	Sanofi BG Star	4	75.0	25.0	0.0	16.6	6.8	e*
12	Contour NEXT ONE	5	100.0	0.0	0.0	11.6	3.7	e*
13	Accu-Check Guide	117	96.6	1.7	1.7	10.7	4.2	e

Glucose

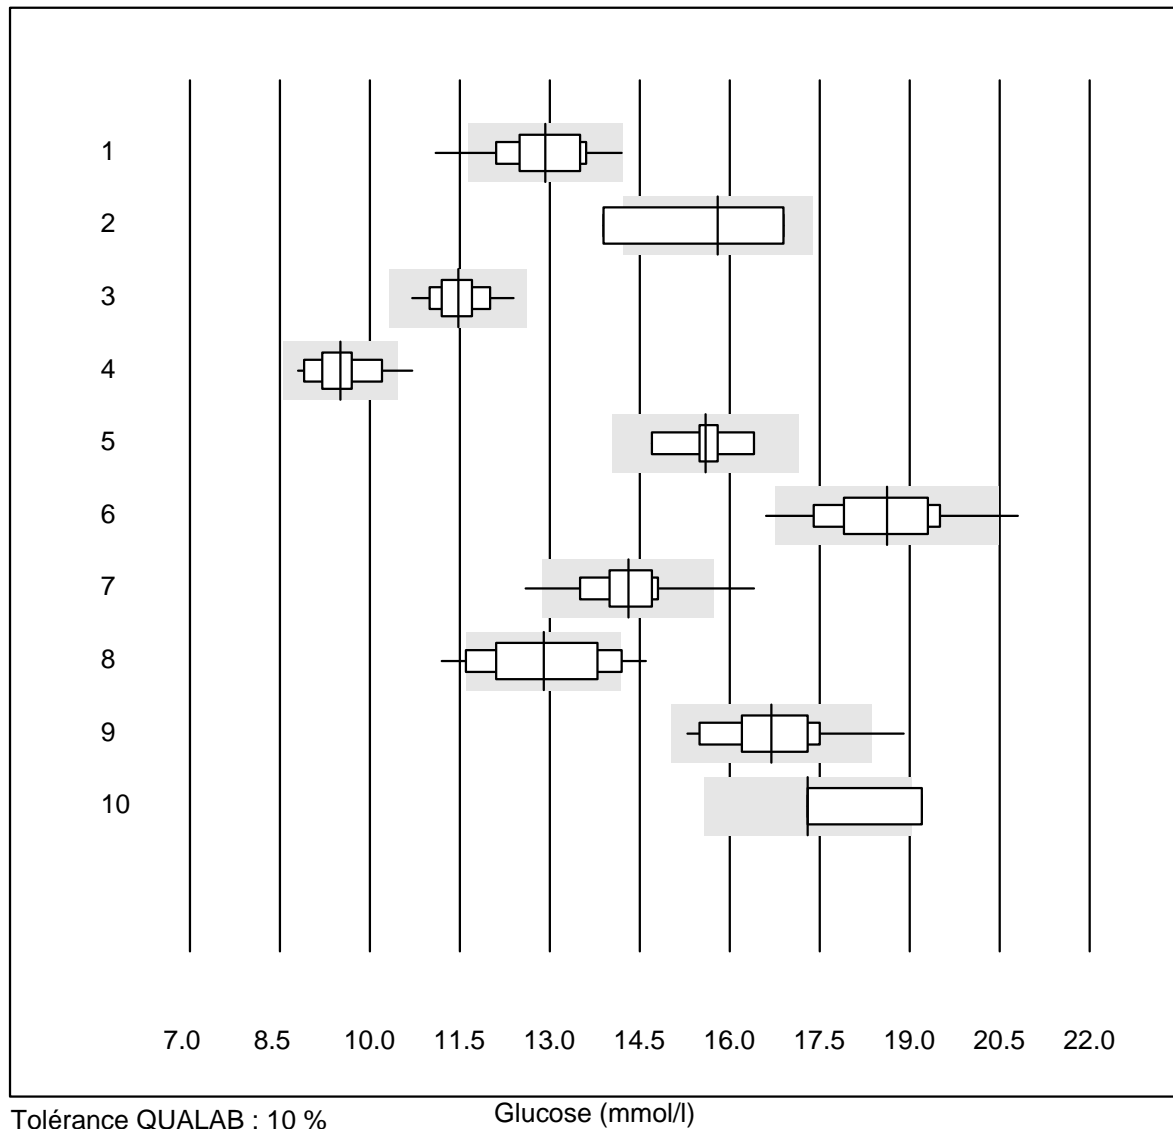

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Hemocue 201+ (alt)	48	97.9	2.1	0.0	12.9	5.0	e
2	OneTouch Ultra	5	40.0	20.0	40.0	15.8	9.8	e*
3	OneTouch Verio	28	100.0	0.0	0.0	11.5	3.2	e
4	Contour 2 (5s)	37	89.2	2.7	8.1	9.5	4.7	e
5	Contour (15s)	6	83.3	0.0	16.7	15.6	3.9	e*
6	Healthpro	34	85.3	5.9	8.8	18.6	5.2	e
7	Mylife UNIO	234	94.9	3.4	1.7	14.3	4.1	e
8	mylife Pura	65	78.5	21.5	0.0	12.9	7.5	e
9	Omnitest	18	94.4	5.6	0.0	16.7	5.2	e*
10	Alpha Check	5	40.0	20.0	40.0	17.3	5.3	e*

Acide urique

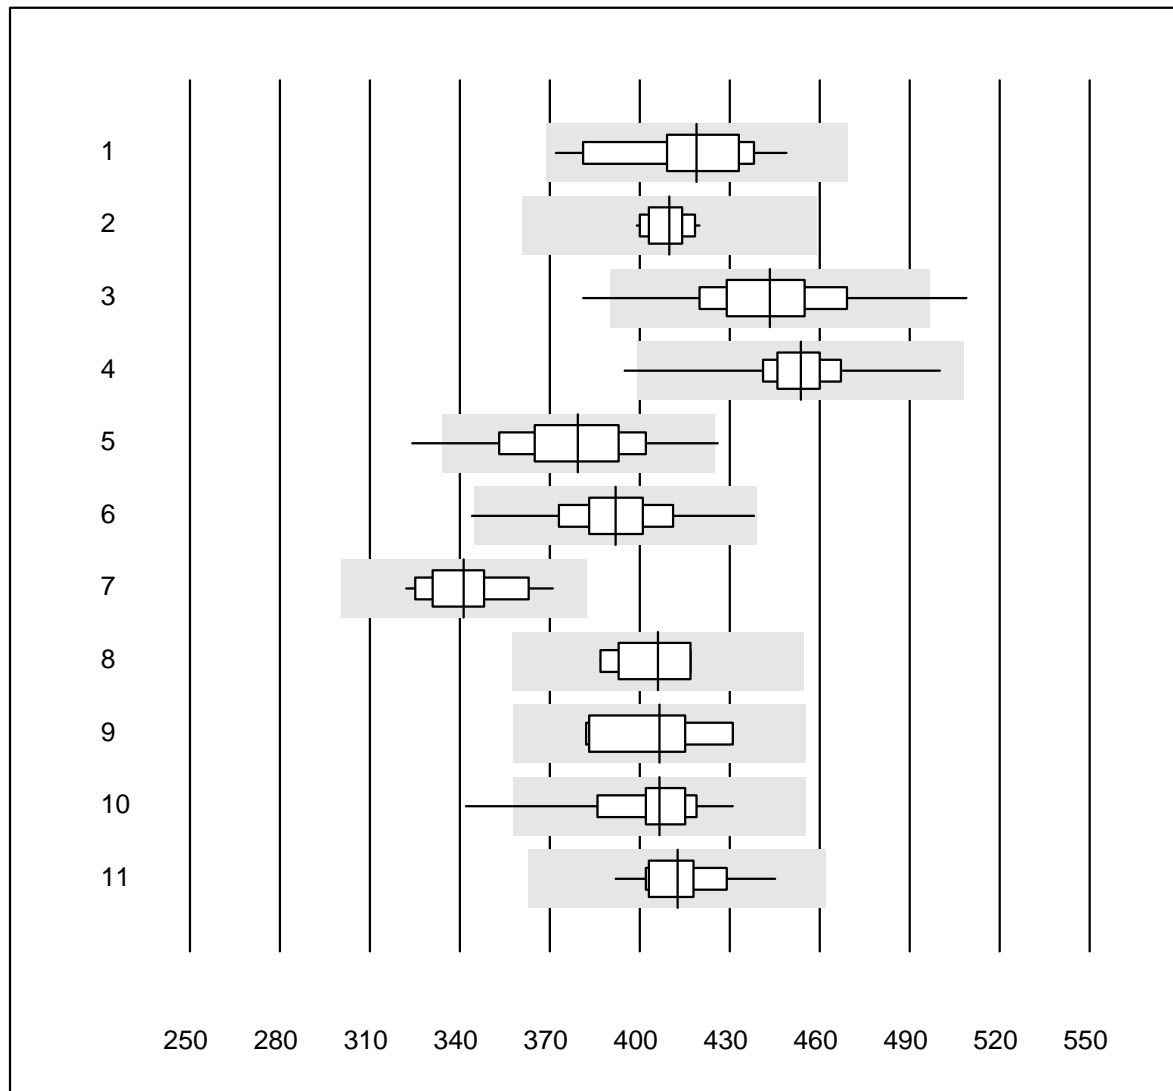


Tolérance QUALAB : 12 %

Acide urique (µmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	30	100.0	0.0	0.0	419	4.5	e
2	Cobas	12	100.0	0.0	0.0	410	1.7	e
3	Reflotron	682	98.9	0.7	0.4	443	4.4	e
4	Fuji Dri-Chem	769	99.8	0.1	0.1	454	2.5	e
5	Spotchem/Ready	95	96.8	2.1	1.1	379	5.3	e
6	Spotchem D-Concept	215	99.0	0.5	0.5	392	3.7	e
7	Piccolo	26	96.2	0.0	3.8	341	4.2	e
8	Skylla	6	100.0	0.0	0.0	406	3.0	e
9	Abx Mira	8	100.0	0.0	0.0	407	4.5	e*
10	Hitachi S40/M40	16	93.7	6.3	0.0	406	4.9	e
11	Autolyser/DiaSys	15	100.0	0.0	0.0	413	3.2	e

Urée

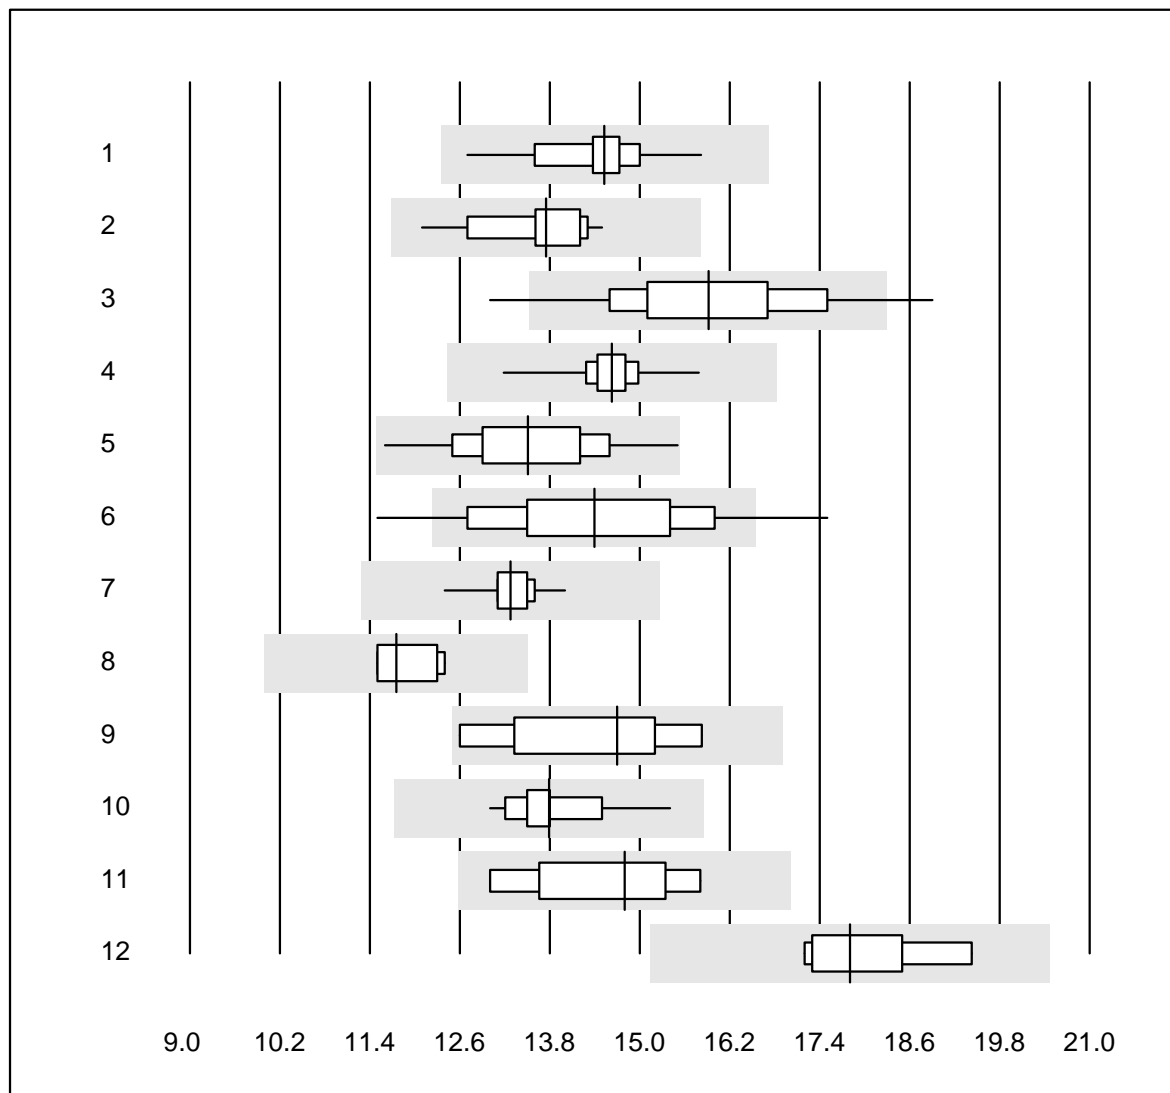


Tolérance QUALAB : 15 %

Urée (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	28	100.0	0.0	0.0	14.5	4.2	e
2	Cobas	14	100.0	0.0	0.0	13.7	4.7	e
3	Reflotron	301	95.0	2.7	2.3	15.9	7.2	e
4	Fuji Dri-Chem	456	99.6	0.0	0.4	14.6	1.9	e
5	Spotchem/Ready	57	98.2	0.0	1.8	13.5	6.4	e
6	Spotchem D-Concept	138	89.9	7.2	2.9	14.4	9.0	e
7	Piccolo	44	97.7	0.0	2.3	13.3	2.1	e
8	Skyla	6	100.0	0.0	0.0	11.8	3.3	e
9	Abx Mira	7	100.0	0.0	0.0	14.7	8.0	e*
10	Hitachi S40/M40	13	100.0	0.0	0.0	13.8	4.4	e
11	Autolyser/DiaSys	9	100.0	0.0	0.0	14.8	6.8	e*
12	iStat Chem8	8	100.0	0.0	0.0	17.8	4.2	e

Potassium

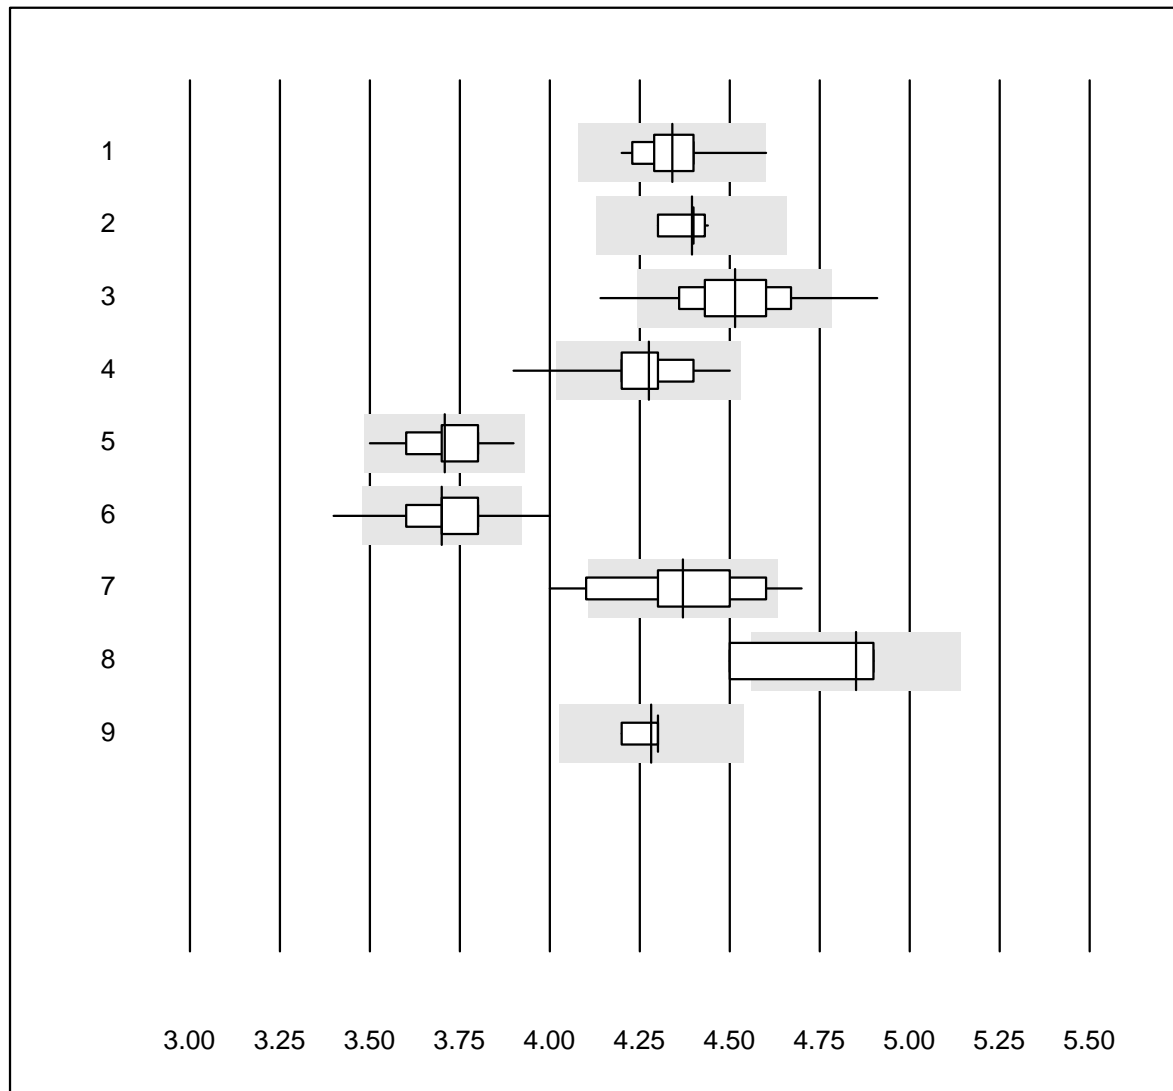


Tolérance QUALAB : 6 %

Potassium (mmol/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	ISE	47	97.9	0.0	2.1	4.34	1.9	e
2	Cobas	16	100.0	0.0	0.0	4.40	0.9	e
3	Reflotron	663	93.0	3.8	3.2	4.51	2.7	e
4	Fuji Dri-Chem	808	96.0	2.5	1.5	4.27	2.0	e
5	Spotchem D-Concept	216	98.6	0.0	1.4	3.71	2.1	e
6	Spotchem EL-SE 1520	103	95.1	3.9	1.0	3.70	2.7	e
7	Piccolo	33	78.8	12.1	9.1	4.37	3.8	e
8	Skyla	4	75.0	25.0	0.0	4.85	4.0	e*
9	iStat Chem8	11	100.0	0.0	0.0	4.28	0.9	e

Créatinine

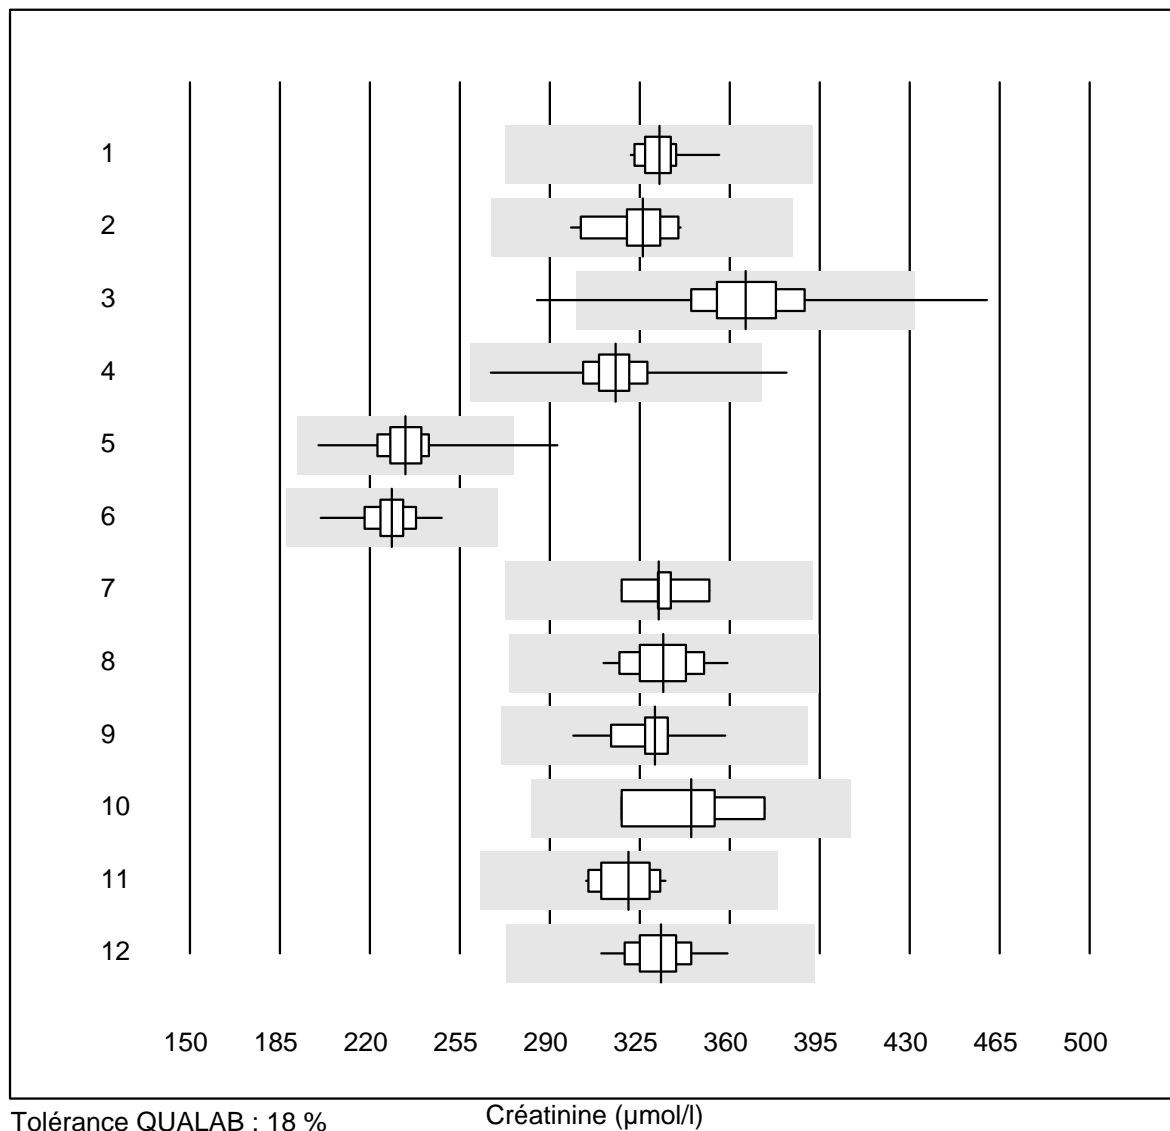

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	22	95.5	0.0	4.5	333	2.7	e
2	Cobas	17	100.0	0.0	0.0	326	3.7	e
3	Reflotron	869	98.1	1.0	0.9	366	5.4	e
4	Fuji Dri-Chem	838	99.0	0.5	0.5	316	3.5	e
5	Spotchem/Ready	126	99.2	0.8	0.0	234	4.3	e
6	Spotchem D-Concept	225	100.0	0.0	0.0	228	3.5	e
7	Enzymatisch	6	100.0	0.0	0.0	332	3.3	e
8	Piccolo	45	100.0	0.0	0.0	334	3.7	e
9	Abx Mira	11	100.0	0.0	0.0	331	4.4	e
10	Skyla	7	100.0	0.0	0.0	345	5.7	e*
11	Hitachi S40/M40	17	94.1	0.0	5.9	321	3.2	e
12	Autolyser/DiaSys	17	100.0	0.0	0.0	333	3.5	e

Créatinine E

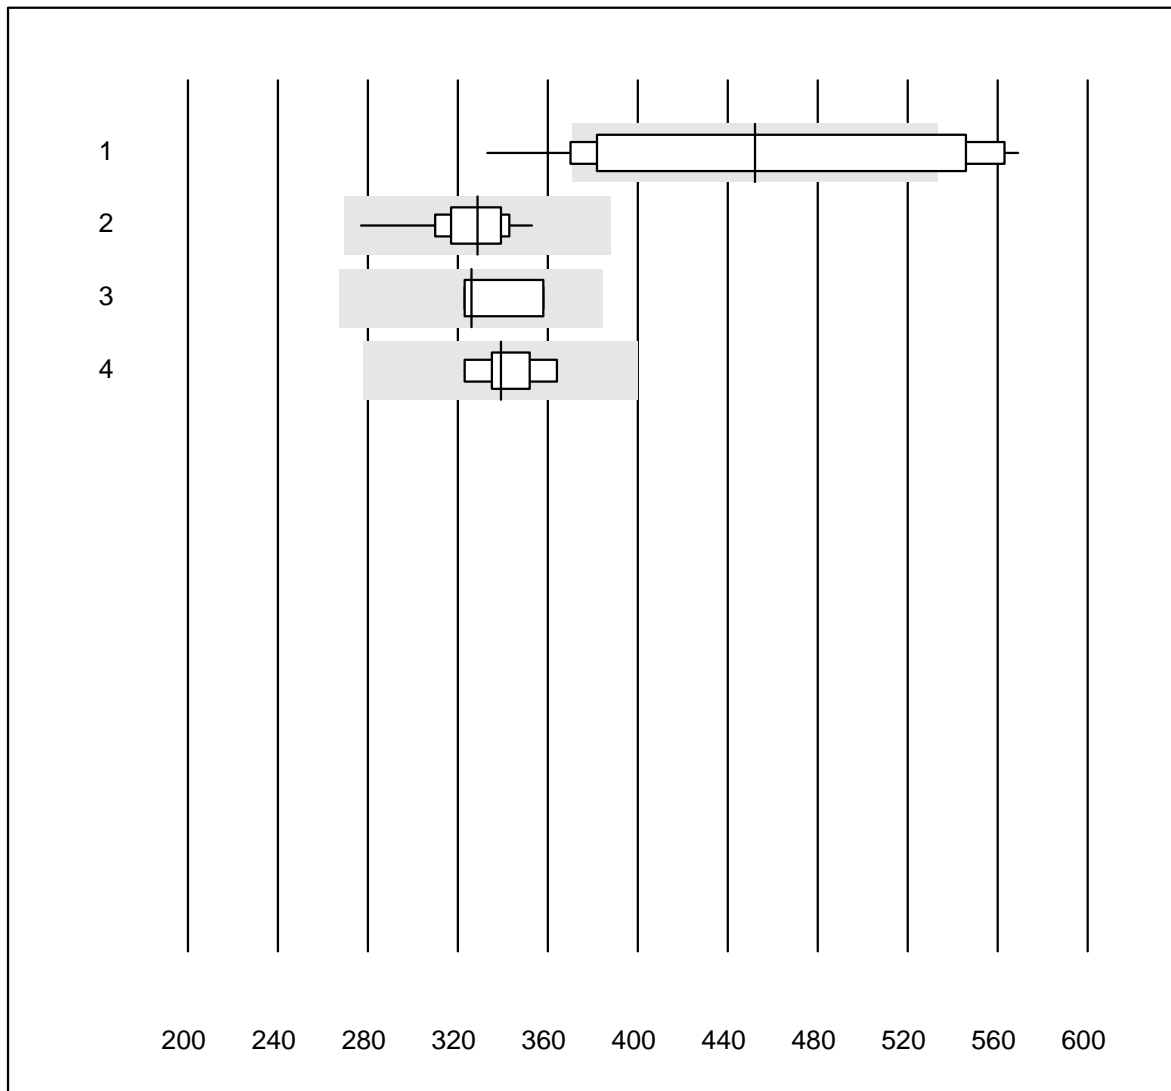


Tolérance QUALAB : 18 %

Créatinine E (µmol/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Statsensor i / Nova	45	55.5	35.6	8.9	452	17.2	e*
2 iStat Chem8	12	100.0	0.0	0.0	329	6.1	e
3 EPOC	4	75.0	0.0	25.0	326	5.6	e*
4 ABL700/800	9	100.0	0.0	0.0	339	3.9	e

eGFR CKD-EPI

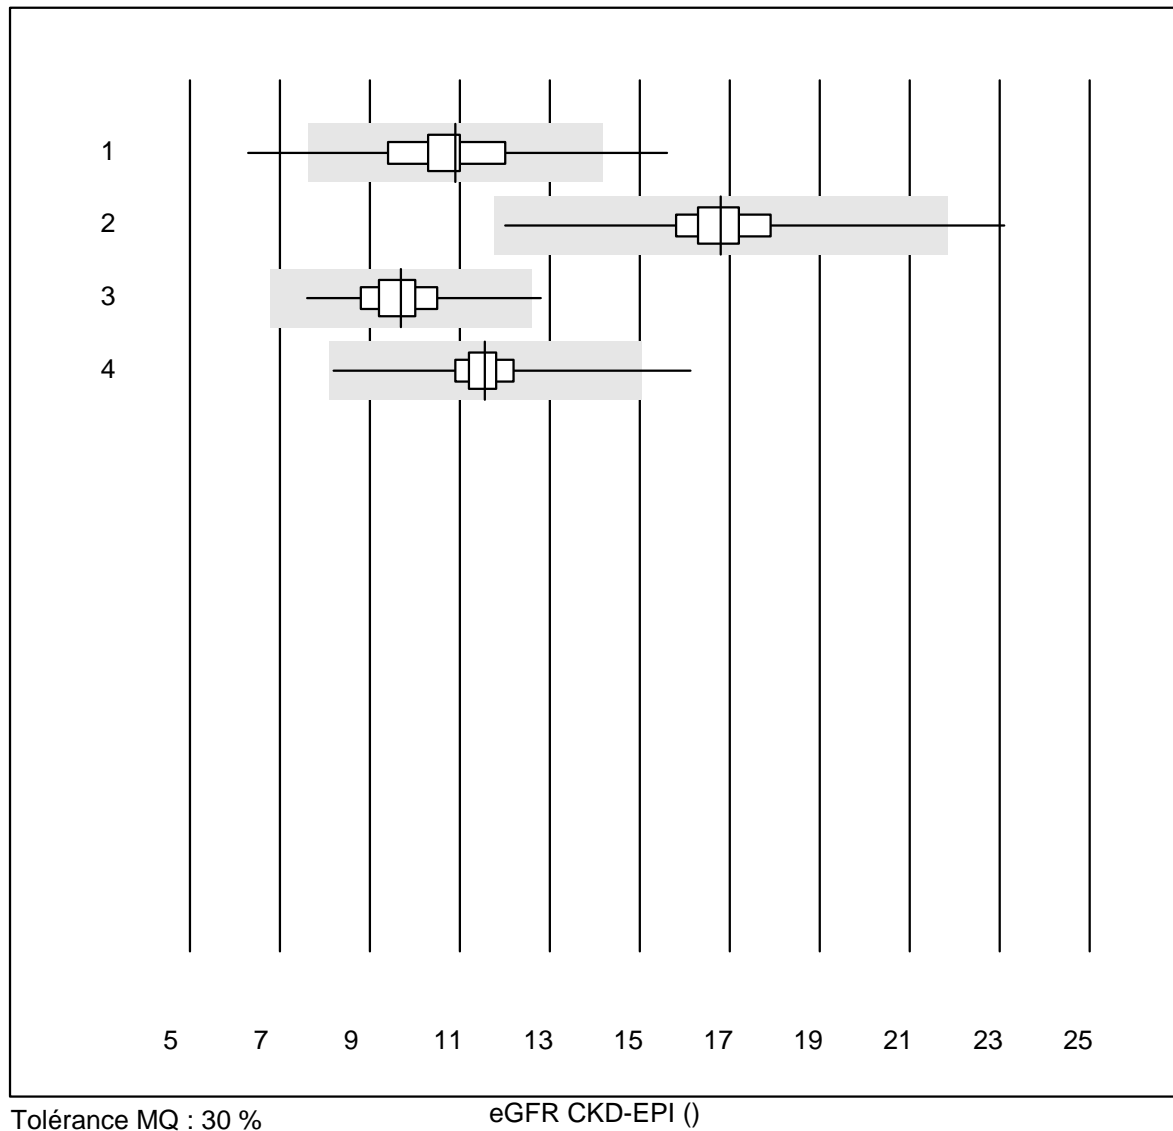


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	68	86.8	8.8	4.4	11	14.2	e
2	Spotchem/Ready	130	94.6	0.8	4.6	17	7.1	e
3	Reflotron	305	97.4	1.0	1.6	10	8.0	e
4	Fuji Dri-Chem	348	95.2	1.4	3.4	12	7.7	e

eGFR Cockcroft-Gault

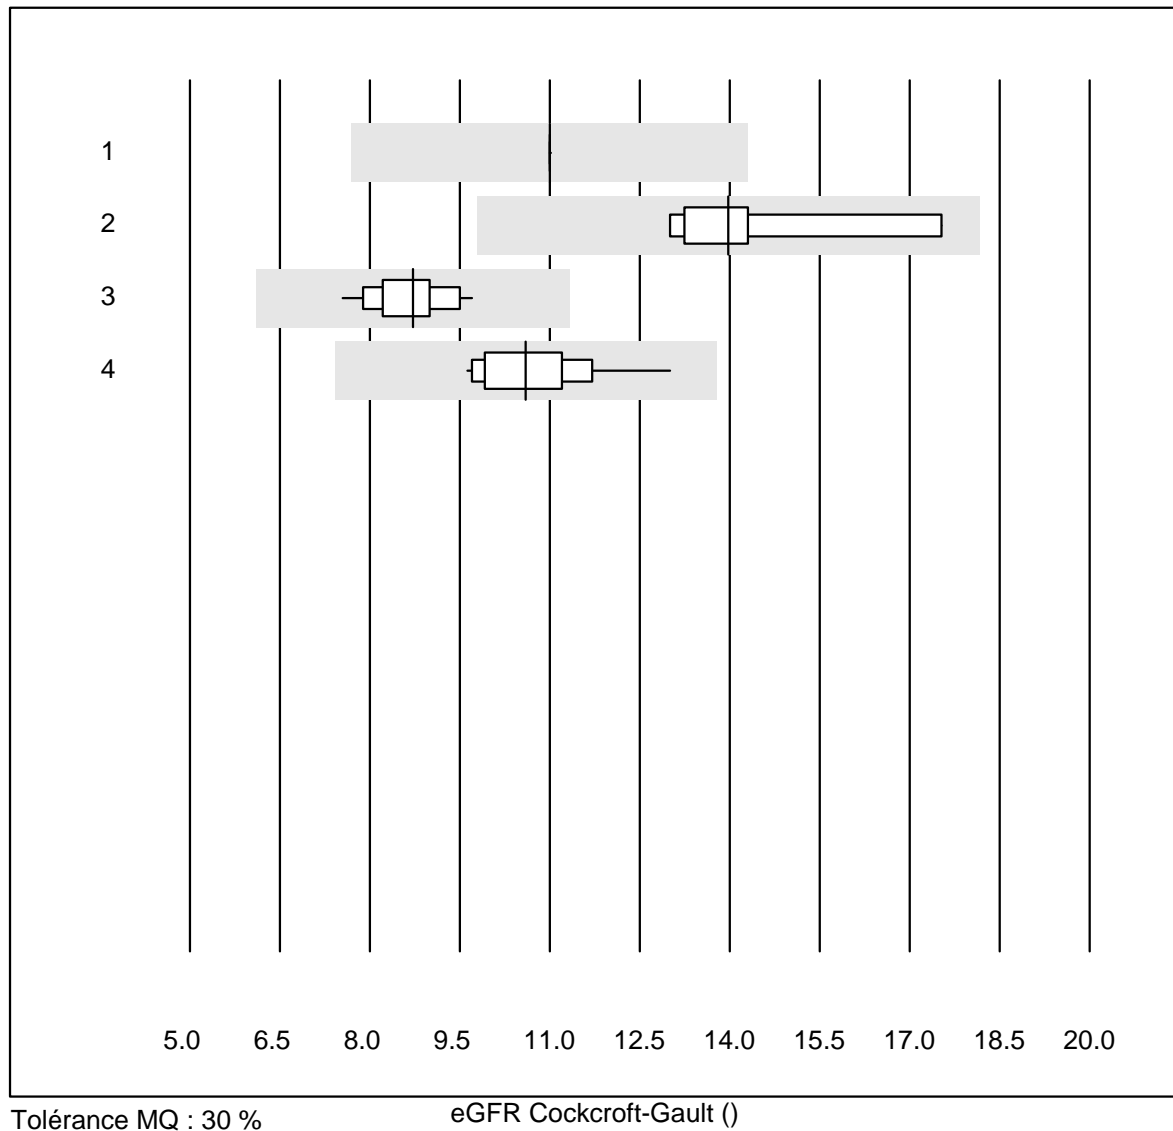

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Chimie humide	4	75.0	0.0	25.0	11	0.0	e
2 Spotchem/Ready	9	100.0	0.0	0.0	14	9.8	e
3 Reflotron	21	95.2	0.0	4.8	9	6.6	e
4 Fuji Dri-Chem	23	87.0	0.0	13.0	11	8.8	e

eGFR MDRD

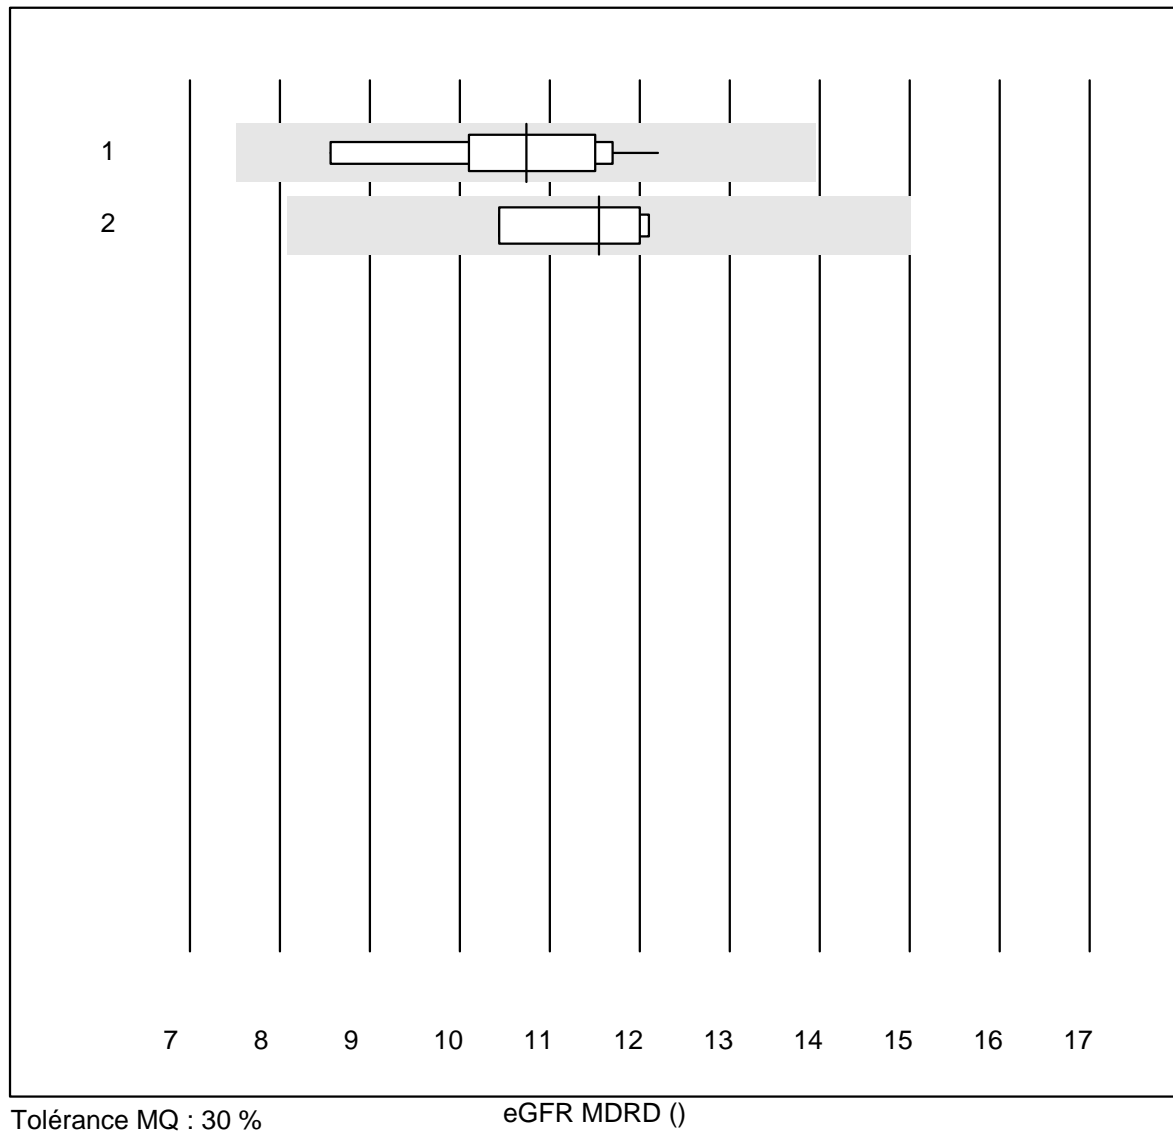


Tolérance MQ : 30 %

eGFR MDRD ()


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Reflotron	11	90.9	0.0	9.1	11	9.8	e
2 Fuji Dri-Chem	4	100.0	0.0	0.0	12	6.9	e

LDH

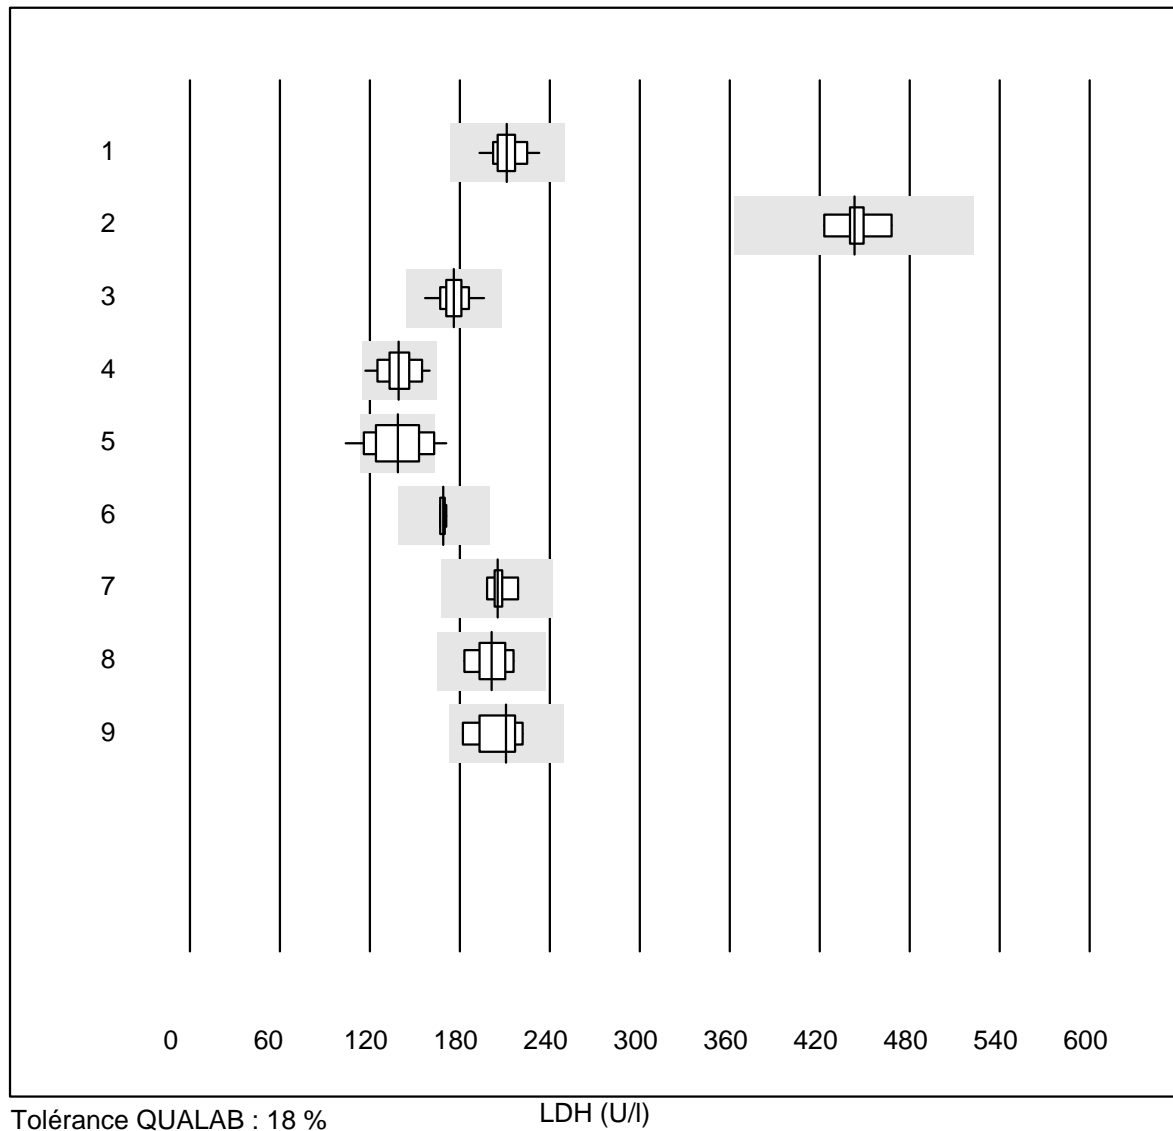

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 IFCC	29	100.0	0.0	0.0	211	4.5	e
2 Cobas	9	100.0	0.0	0.0	443	2.8	e
3 Fuji Dri-Chem	145	97.9	0.0	2.1	176	4.4	e
4 Spotchem/Ready	15	93.3	0.0	6.7	139	8.2	e
5 Spotchem D-Concept	44	79.6	6.8	13.6	139	12.4	e
6 Piccolo	4	100.0	0.0	0.0	169	1.1	e
7 Abx Mira	7	85.7	0.0	14.3	205	3.4	e
8 Hitachi S40/M40	6	100.0	0.0	0.0	201	6.0	e*
9 Autolyser/DiaSys	8	100.0	0.0	0.0	211	6.8	e*

Magnésium

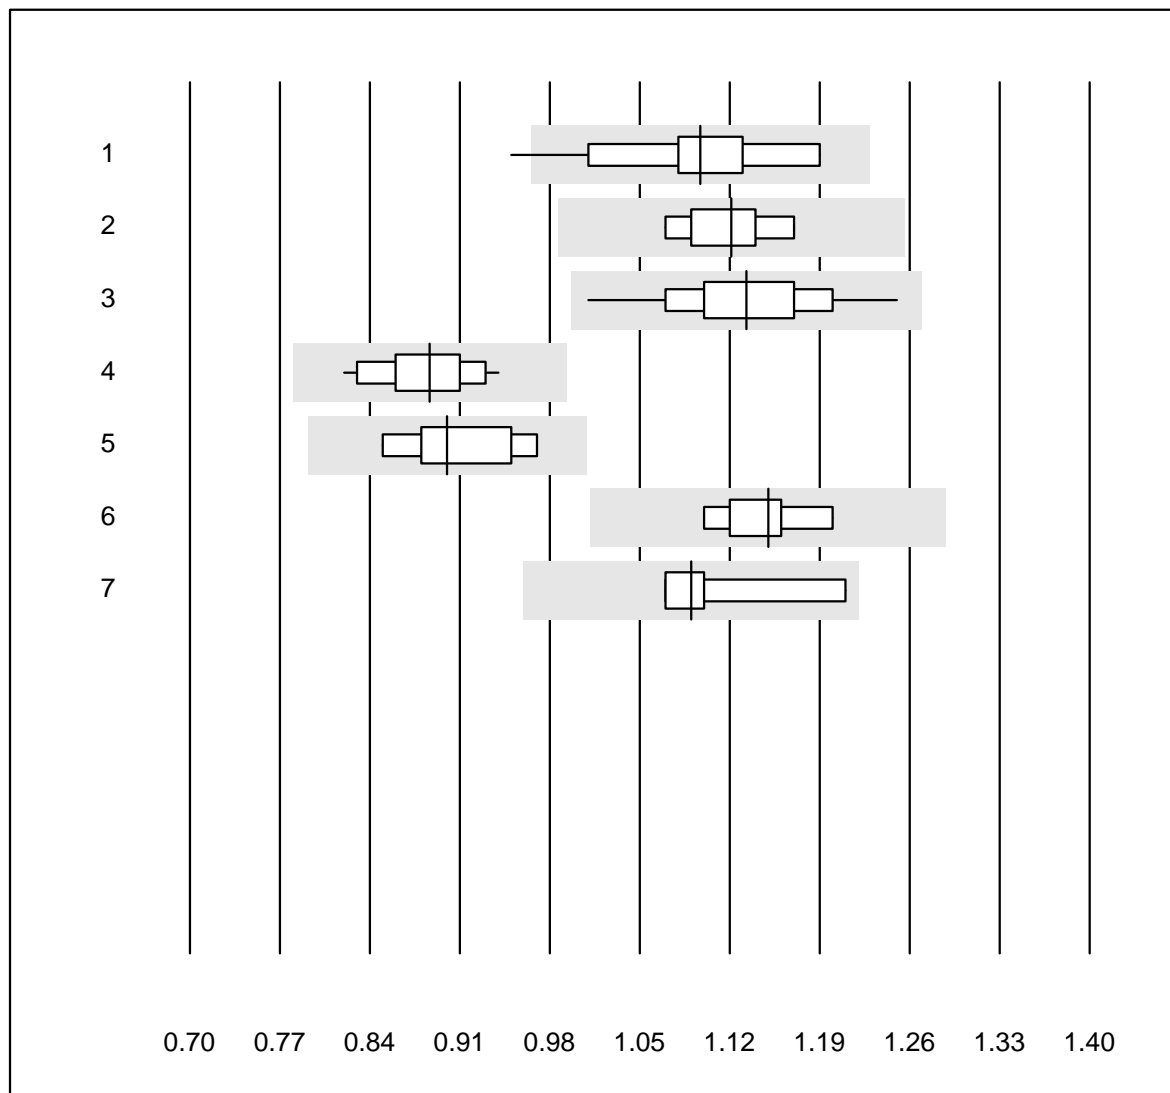


Tolérance QUALAB : 12 %

Magnésium (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	14	92.9	7.1	0.0	1.10	5.8	e*
2	Cobas	10	100.0	0.0	0.0	1.12	3.1	e
3	Fuji Dri-Chem	110	99.1	0.0	0.9	1.13	4.4	e
4	Spotchem D-Concept	40	100.0	0.0	0.0	0.89	3.9	e
5	Spotchem/Ready	9	100.0	0.0	0.0	0.90	5.1	e*
6	Beckman	8	100.0	0.0	0.0	1.15	2.6	e
7	Piccolo	6	100.0	0.0	0.0	1.09	4.8	e*

Sodium

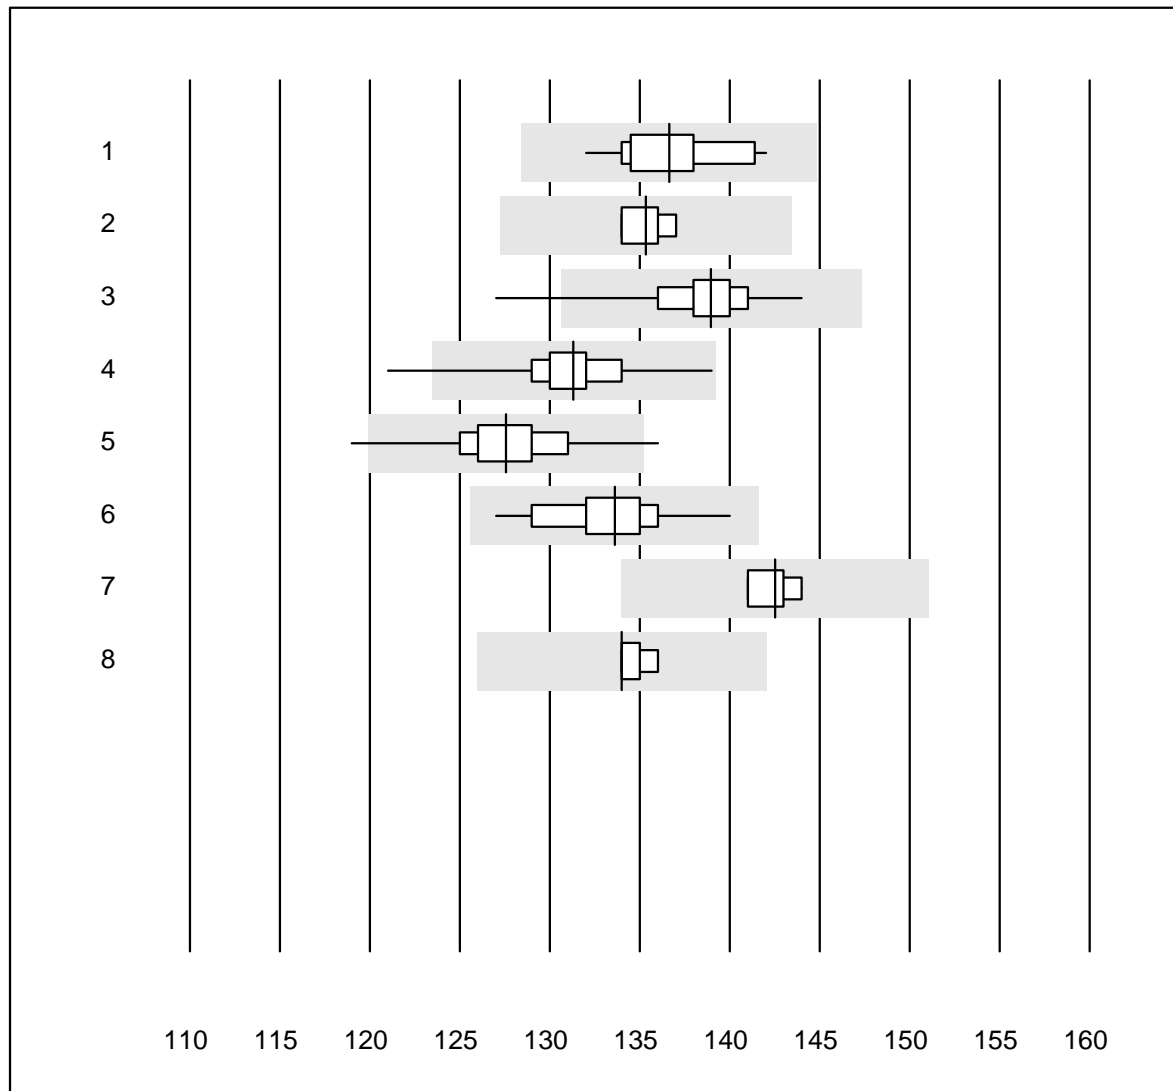


Tolérance QUALAB : 6 %

Sodium (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	ISE	44	100.0	0.0	0.0	137	2.0	e
2	Cobas	16	93.7	0.0	6.3	135	0.8	e
3	Fuji Dri-Chem	751	97.2	1.7	1.1	139	1.7	e
4	Spotchem D-Concept	207	98.0	1.0	1.0	131	1.8	e
5	Spotchem EL-SE 1520	103	97.1	1.9	1.0	128	2.3	e
6	Piccolo	34	97.1	0.0	2.9	134	2.2	e
7	Skyla	4	100.0	0.0	0.0	143	0.9	e
8	iStat Chem8	9	100.0	0.0	0.0	134	0.5	e

Phosphates

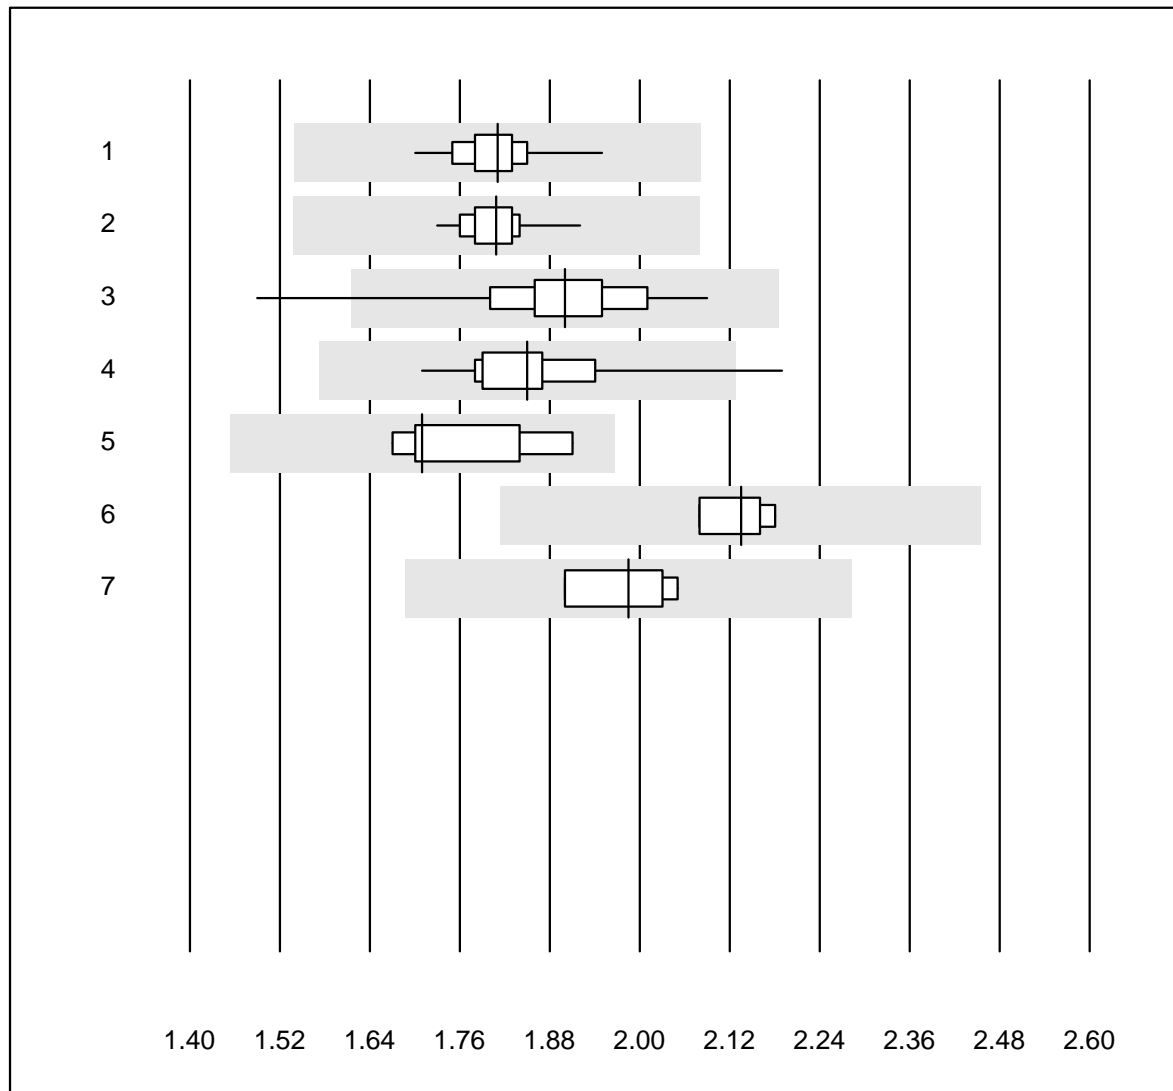


Tolérance QUALAB : 15 %

Phosphates (mmol/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	21	100.0	0.0	0.0	1.8	3.2	e
2	Cobas	11	100.0	0.0	0.0	1.8	2.7	e
3	Fuji Dri-Chem	81	98.8	1.2	0.0	1.9	4.5	e
4	Spotchem D-Concept	22	95.5	4.5	0.0	1.9	5.3	e
5	Spotchem/Ready	7	100.0	0.0	0.0	1.7	5.1	e*
6	Piccolo	4	100.0	0.0	0.0	2.1	2.1	e
7	Skyla	4	100.0	0.0	0.0	2.0	3.6	e*

Protéine

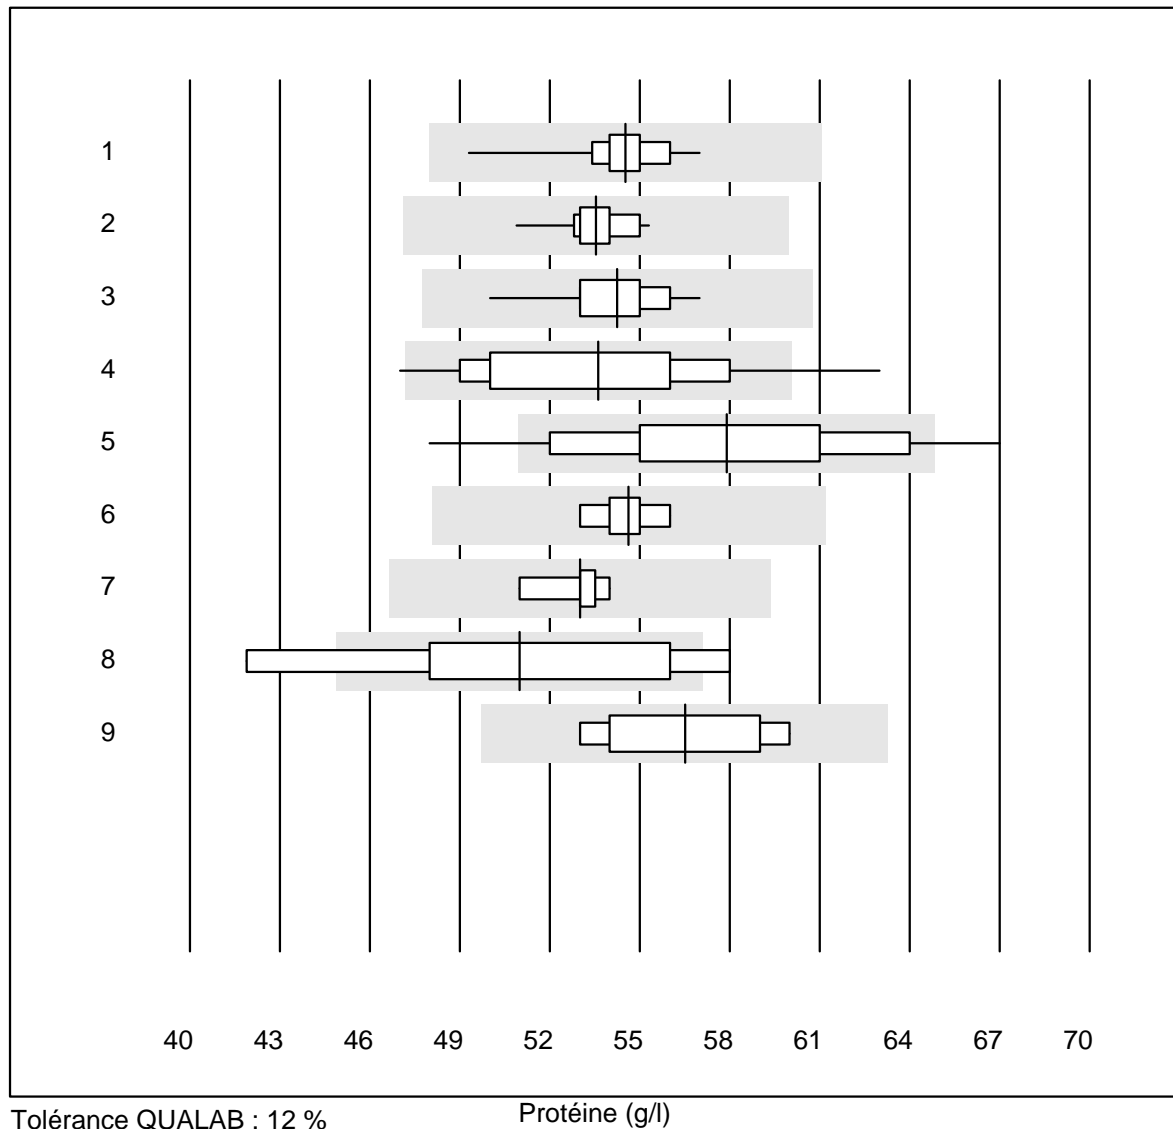

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	26	100.0	0.0	0.0	54.5	2.6	e
2	Cobas	12	100.0	0.0	0.0	53.5	2.2	e
3	Fuji Dri-Chem	177	100.0	0.0	0.0	54.3	2.3	e
4	Spotchem/Ready	29	93.1	6.9	0.0	53.6	7.1	e
5	Spotchem D-Concept	97	87.6	12.4	0.0	57.9	7.3	e
6	Piccolo	30	100.0	0.0	0.0	54.6	1.6	e
7	Skyla	6	100.0	0.0	0.0	53.0	1.9	e
8	Abx Mira	6	66.7	33.3	0.0	51.0	11.4	e*
9	Hitachi S40/M40	7	100.0	0.0	0.0	56.5	4.4	e*

Transaminase GOT/AST

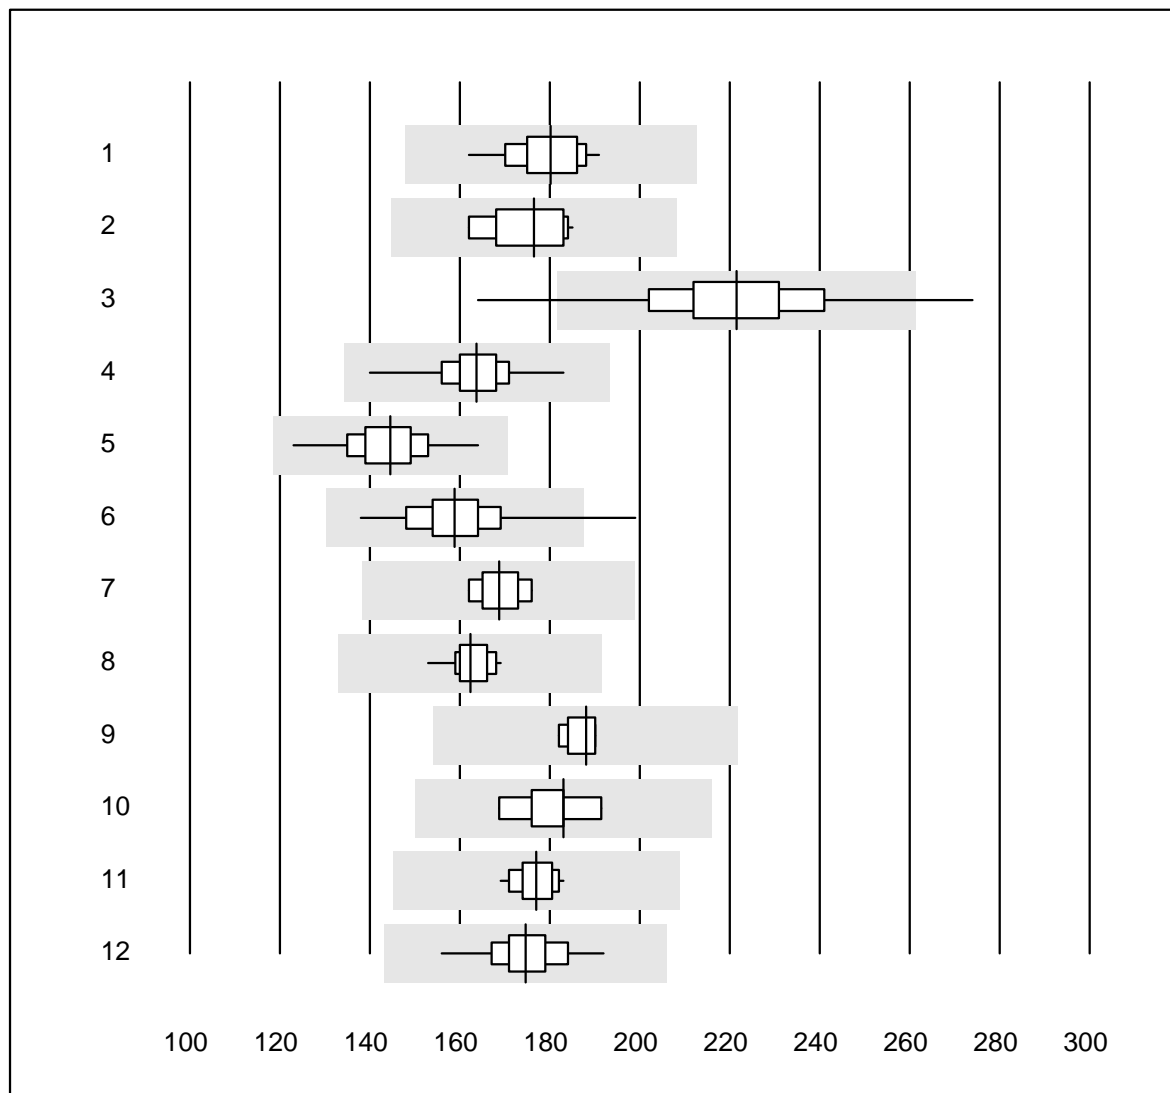


Tolérance QUALAB : 18 %

Transaminase GOT/AST (U/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	IFCC avec PP	31	100.0	0.0	0.0	180	3.9	e
2	Cobas	10	100.0	0.0	0.0	176	5.0	e
3	Reflotron	772	96.4	2.3	1.3	221	7.2	e
4	Fuji Dri-Chem	819	99.8	0.0	0.2	164	3.8	e
5	Spotchem/Ready	120	100.0	0.0	0.0	145	5.0	e
6	Spotchem D-Concept	226	99.2	0.4	0.4	159	5.3	e
7	IFCC sens PP	7	100.0	0.0	0.0	169	2.8	e
8	Piccolo	45	100.0	0.0	0.0	162	2.3	e
9	Skyla	7	100.0	0.0	0.0	188	1.8	e
10	Abx Mira	9	100.0	0.0	0.0	183	3.7	e
11	Hitachi S40/M40	19	89.5	0.0	10.5	177	2.3	e
12	Autolyser/DiaSys	17	100.0	0.0	0.0	175	4.5	e

Transaminase GPT/ALT

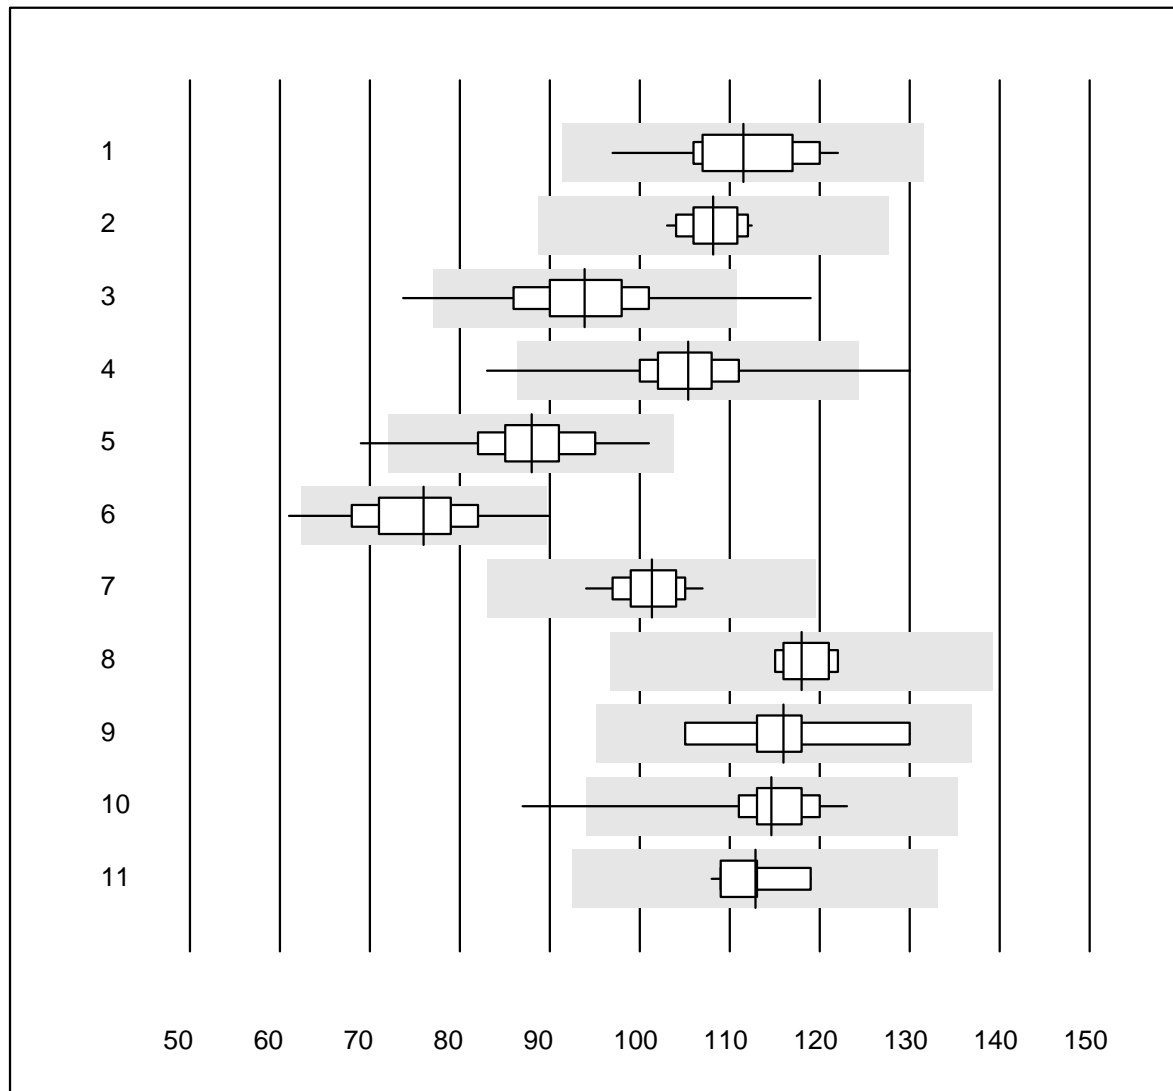


Tolérance QUALAB : 18 %

Transaminase GPT/ALT (U/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	IFCC avec PP	31	100.0	0.0	0.0	111	5.4	e
2	Cobas	17	100.0	0.0	0.0	108	2.7	e
3	Reflotron	800	98.6	0.9	0.5	94	6.5	e
4	Fuji Dri-Chem	834	99.2	0.2	0.6	105	4.5	e
5	Spotchem/Ready	124	96.8	3.2	0.0	88	6.7	e
6	Spotchem D-Concept	232	96.9	0.9	2.2	76	7.2	e
7	Piccolo	46	97.8	0.0	2.2	101	3.0	e
8	Skyla	7	100.0	0.0	0.0	118	2.3	e
9	Abx Mira	9	88.9	0.0	11.1	116	6.3	e
10	Hitachi S40/M40	19	94.7	5.3	0.0	115	6.4	e
11	Autolyser/DiaSys	17	94.1	0.0	5.9	113	3.2	e

Triglycérides

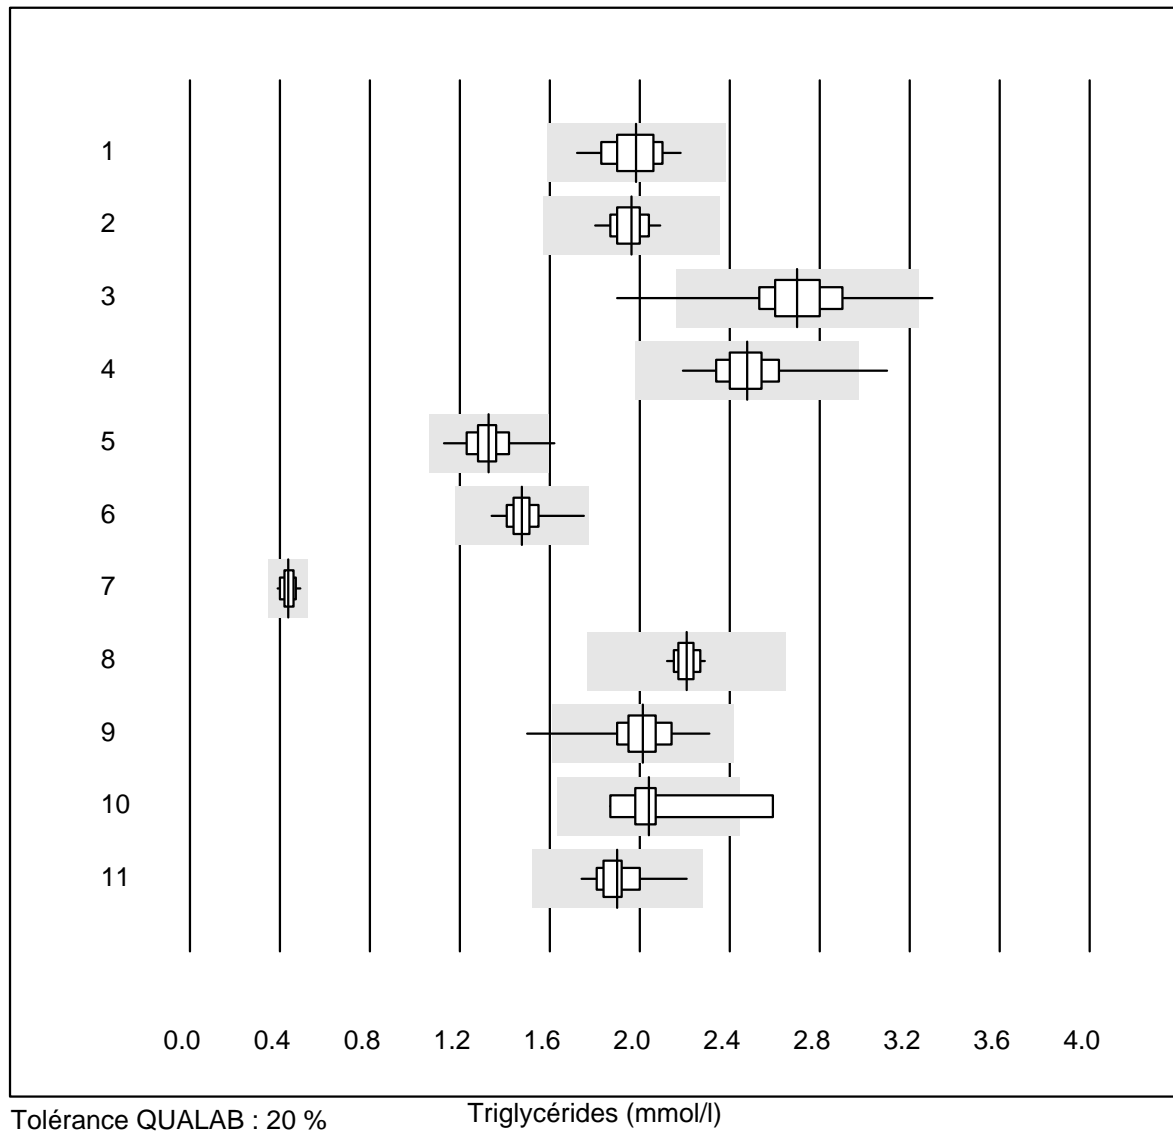


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	27	100.0	0.0	0.0	1.98	5.5	e
2	Cobas	18	94.4	0.0	5.6	1.96	3.6	e
3	Reflotron	517	97.3	0.4	2.3	2.70	5.7	e
4	Fuji Dri-Chem	727	99.4	0.3	0.3	2.48	4.5	e
5	Spotchem/Ready	101	96.0	3.0	1.0	1.33	6.5	e
6	Spotchem D-Concept	206	99.5	0.0	0.5	1.48	3.9	e
7	Hitachi S40/M40	15	93.3	0.0	6.7	0.44	6.4	e
8	Piccolo	20	90.0	0.0	10.0	2.21	2.1	e
9	Cholestech LDX	152	96.7	0.7	2.6	2.01	5.3	e
10	Abx Mira	9	88.9	11.1	0.0	2.04	10.0	e*
11	Autolyser/DiaSys	16	100.0	0.0	0.0	1.90	5.4	e

Lithium

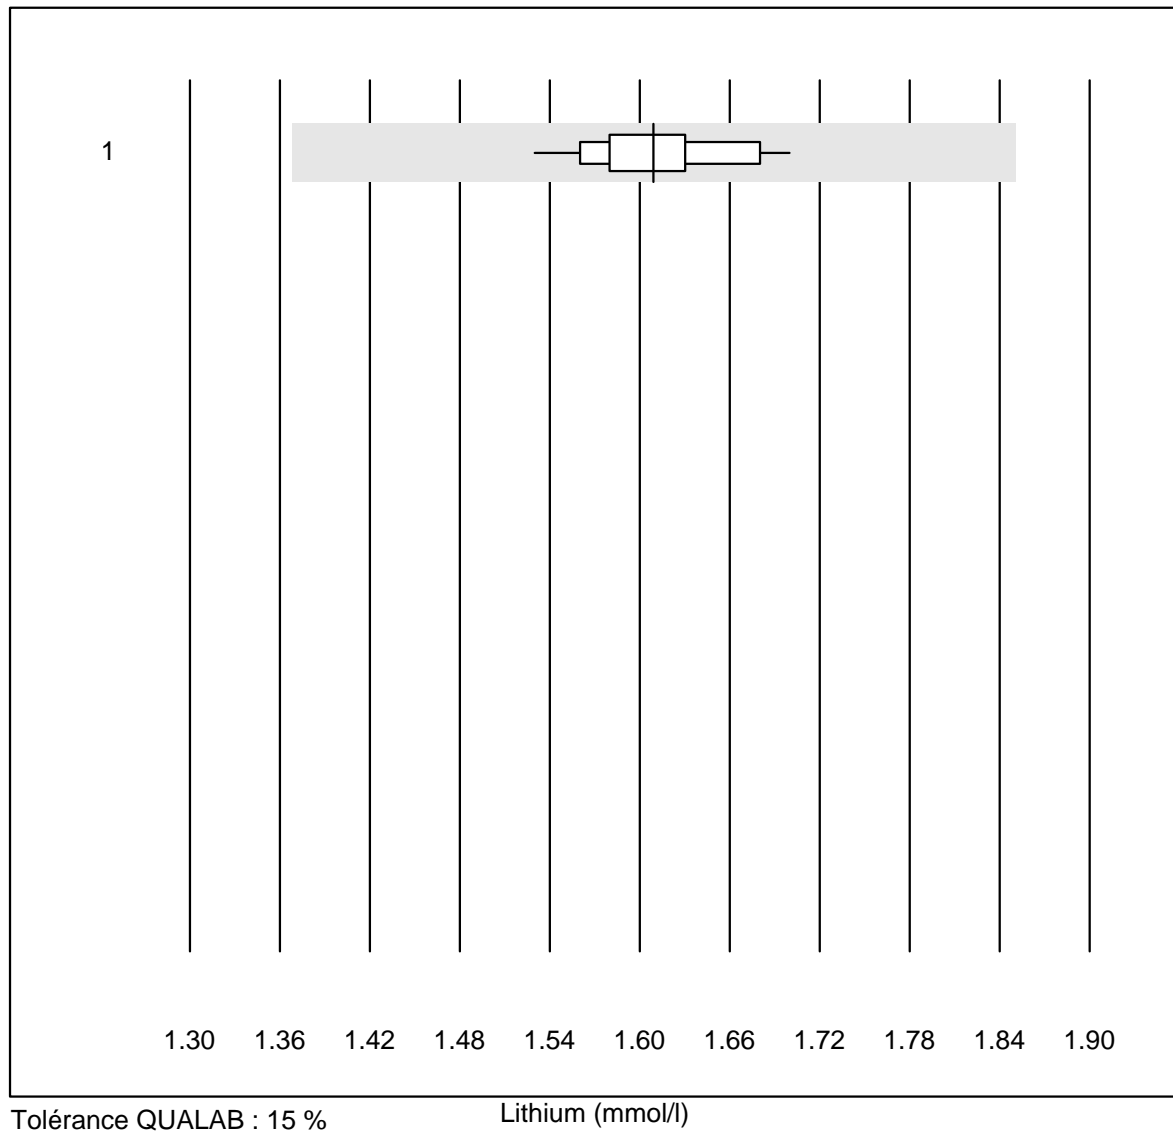


No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 toutes les méthodes	15	100.0	0.0	0.0	1.61	2.8	e

Laktat

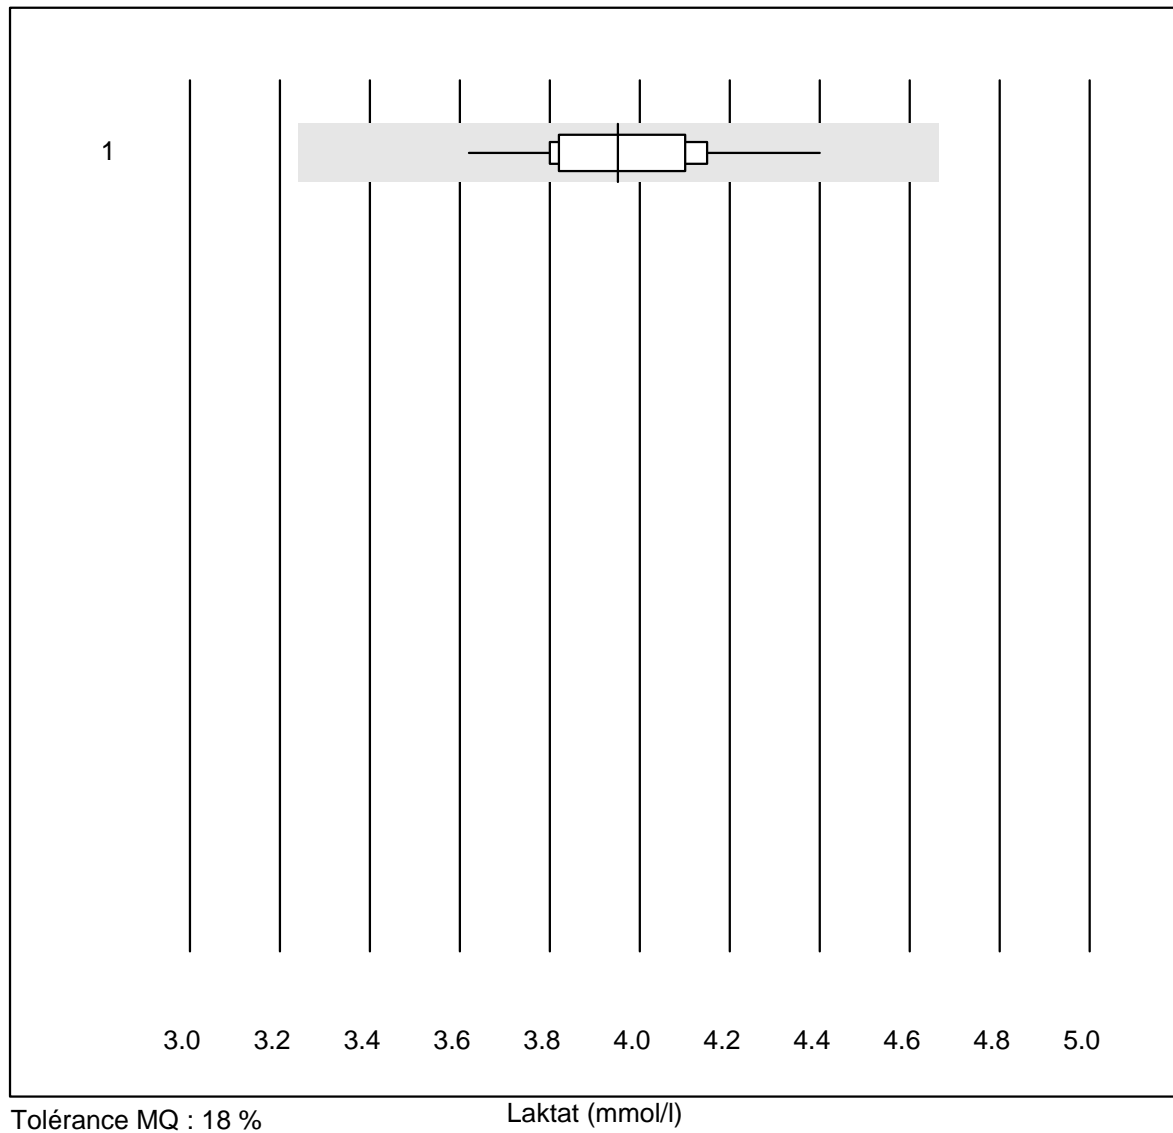

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 toutes les méthodes	11	100.0	0.0	0.0	3.95	5.2	e

HbA1c échantillon A

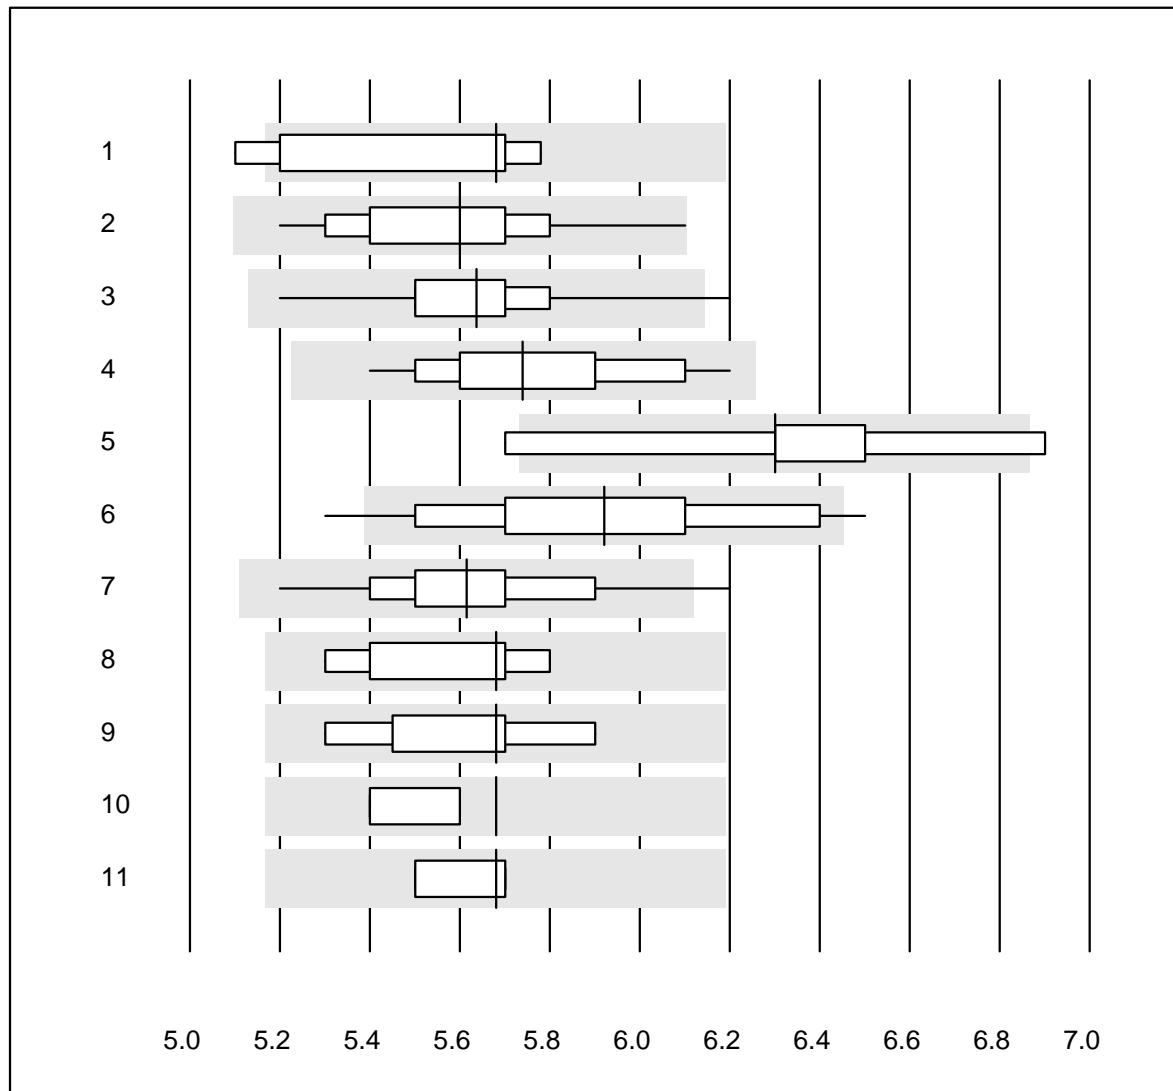


Tolérance QUALAB : 9 %

HbA1c échantillon A (%)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	AFIAS	9	77.8	11.1	11.1	5.7	4.6	a
2	Cobas b101	49	100.0	0.0	0.0	5.6	3.3	e
3	Afinion	776	99.6	0.4	0.0	5.6	2.5	e
4	Eurolyser	16	93.7	0.0	6.3	5.7	3.8	e
5	Hemocue HbA1c 501	9	77.8	22.2	0.0	6.3	6.0	e*
6	NycoCard	59	91.5	5.1	3.4	5.9	5.1	e
7	DCA2000/Vantage	206	97.5	1.0	1.5	5.6	3.5	e
8	Andere	17	94.1	0.0	5.9	5.7	3.0	a
9	HPLC	7	100.0	0.0	0.0	5.7	3.4	a
10	Roche, Cobas	14	85.7	0.0	14.3	5.7	1.6	a
11	A1c Now	4	100.0	0.0	0.0	5.7	2.1	a


HbA1c échantillon B

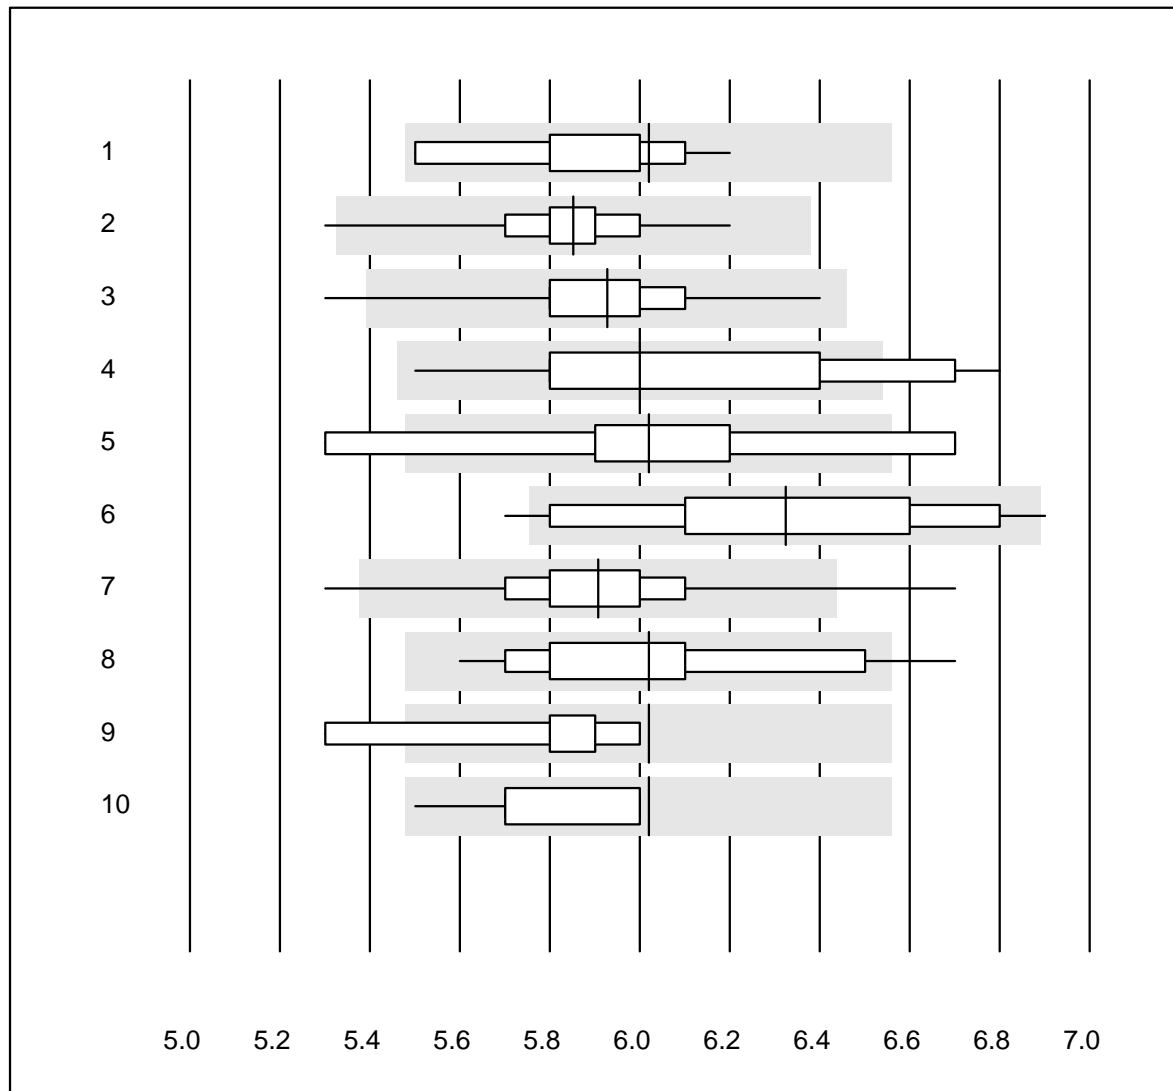

Tolérance QUALAB : 9 %


HbA1c échantillon B (%)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	AFIAS	12	100.0	0.0	0.0	6.0	3.6	a
2	Cobas b101	36	97.2	2.8	0.0	5.9	2.9	e
3	Afinion	597	99.5	0.2	0.3	5.9	2.4	e
4	Eurolyser	14	78.6	14.3	7.1	6.0	6.2	e*
5	Hemocue HbA1c 501	6	66.7	33.3	0.0	6.0	7.6	a
6	NycoCard	40	85.0	10.0	5.0	6.3	5.3	e
7	DCA2000/Vantage	213	98.6	0.9	0.5	5.9	3.3	e
8	Andere	18	94.4	5.6	0.0	6.0	4.6	a
9	HPLC	9	88.9	11.1	0.0	6.0	3.5	a
10	Roche, Cobas	17	88.2	0.0	11.8	6.0	2.5	a

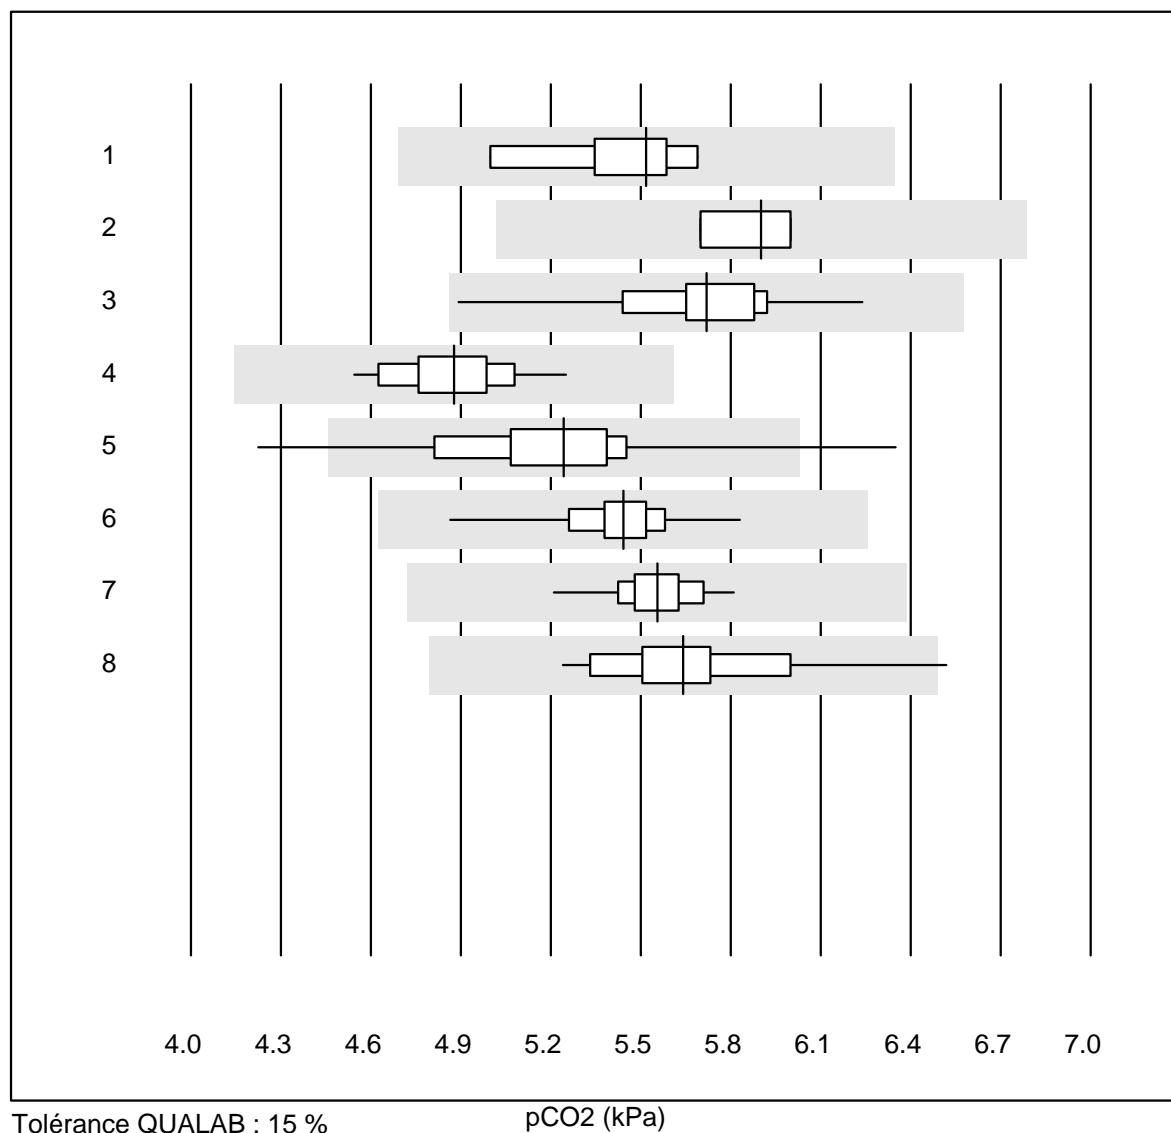pCO₂


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	ABL80 FLEX	8	100.0	0.0	0.0	5.52	3.9	e
2	GEM	7	100.0	0.0	0.0	5.90	2.1	e
3	Cobas	20	100.0	0.0	0.0	5.72	4.7	e
4	iStat	39	97.4	0.0	2.6	4.88	3.3	e
5	EPOC	42	90.4	4.8	4.8	5.24	6.7	e
6	ABL700/800	75	98.7	0.0	1.3	5.44	2.8	e
7	ABL90 FLEX / PLUS	46	100.0	0.0	0.0	5.56	2.1	e
8	ABL80 FLEX CO-OX / O	15	86.6	6.7	6.7	5.64	5.6	e

pO2

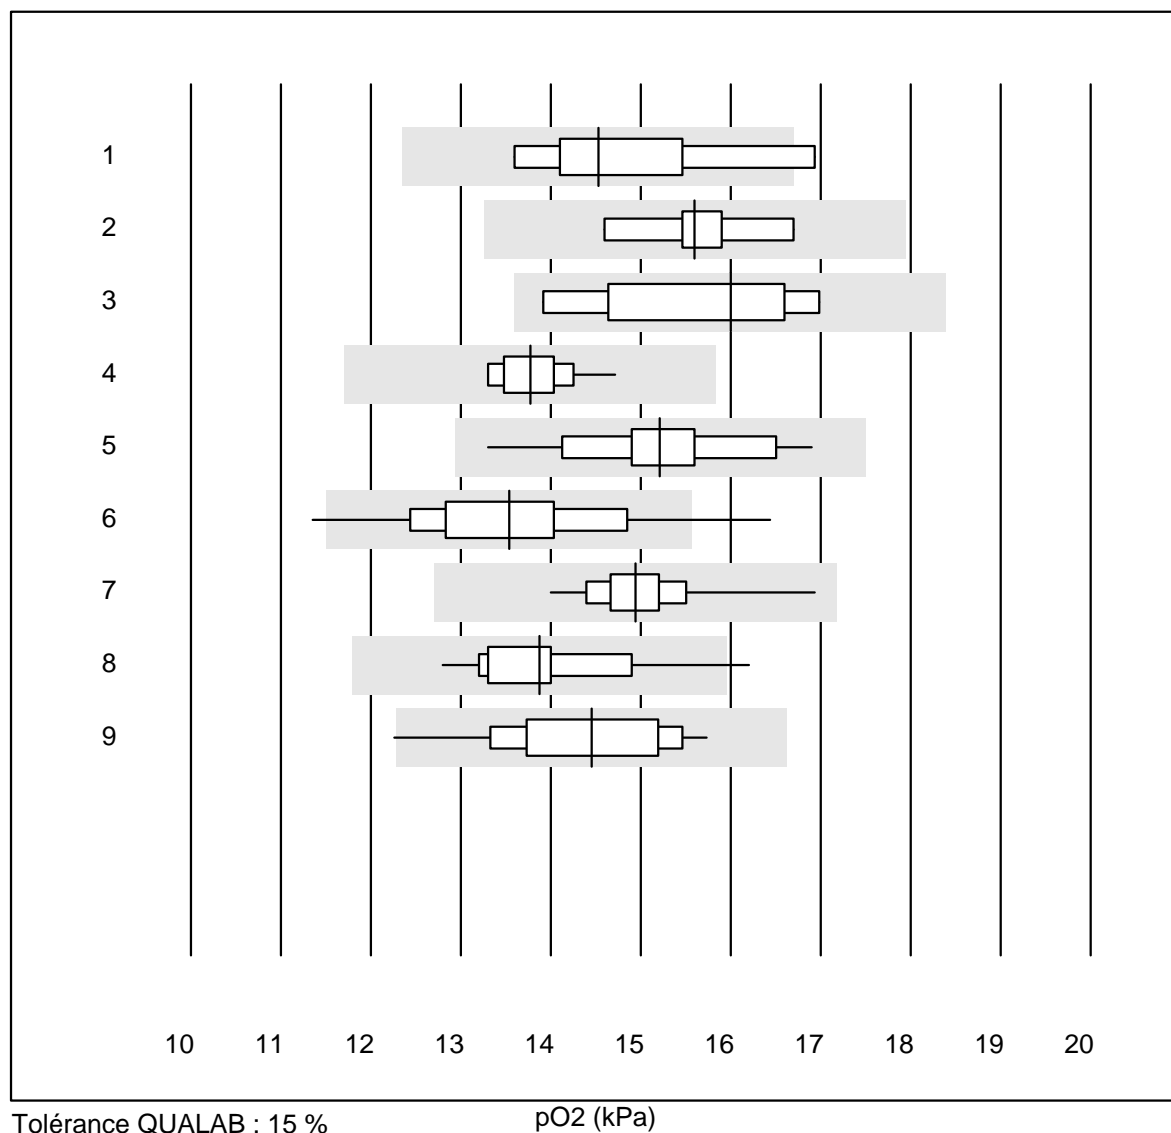


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	ABL80 FLEX	8	75.0	12.5	12.5	14.53	7.5	e*
2	GEM	7	100.0	0.0	0.0	15.60	4.0	e
3	Cobas b221	7	100.0	0.0	0.0	16.00	6.9	e*
4	Cobas b121/123	10	100.0	0.0	0.0	13.77	3.3	e
5	iStat	39	97.4	0.0	2.6	15.21	5.3	e
6	EPOC	42	92.9	7.1	0.0	13.54	7.9	e
7	ABL700/800	74	95.9	0.0	4.1	14.94	3.4	e
8	ABL90 FLEX / PLUS	47	89.3	4.3	6.4	13.87	5.8	e
9	ABL80 FLEX CO-OX / O	15	80.0	6.7	13.3	14.45	7.2	e*

pH

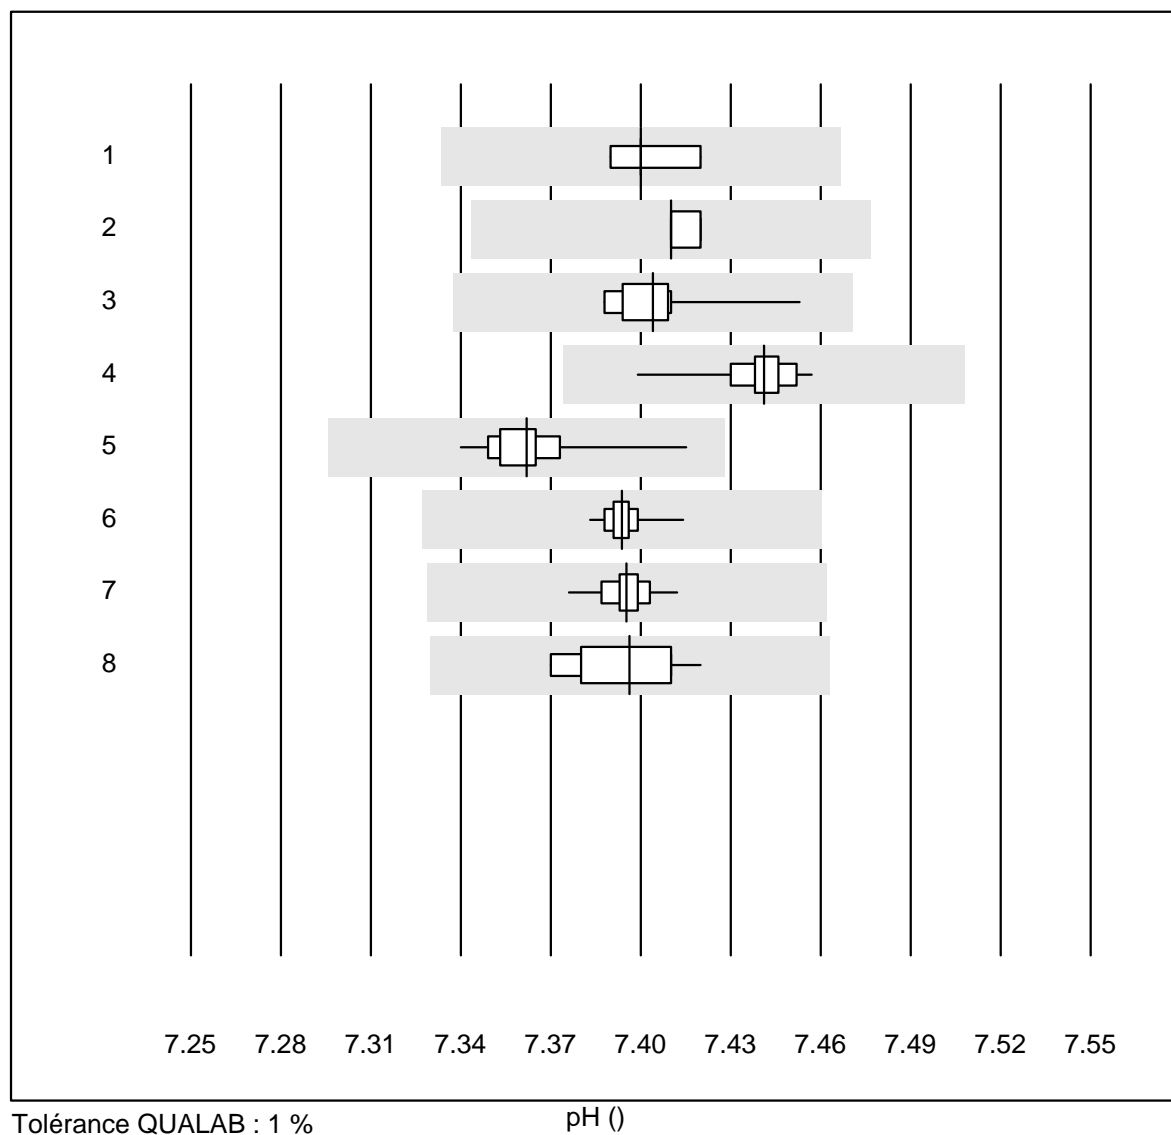

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	ABL80 FLEX	8	100.0	0.0	0.0	7.40	0.1	e
2	GEM	7	100.0	0.0	0.0	7.41	0.1	e
3	Cobas	20	100.0	0.0	0.0	7.40	0.2	e
4	iStat	39	100.0	0.0	0.0	7.44	0.1	e
5	EPOC	41	97.6	0.0	2.4	7.36	0.2	e
6	ABL700/800	75	98.7	0.0	1.3	7.39	0.1	e
7	ABL90 FLEX / PLUS	47	100.0	0.0	0.0	7.40	0.1	e
8	ABL80 FLEX CO-OX / O	15	100.0	0.0	0.0	7.40	0.2	e

Glucose GS

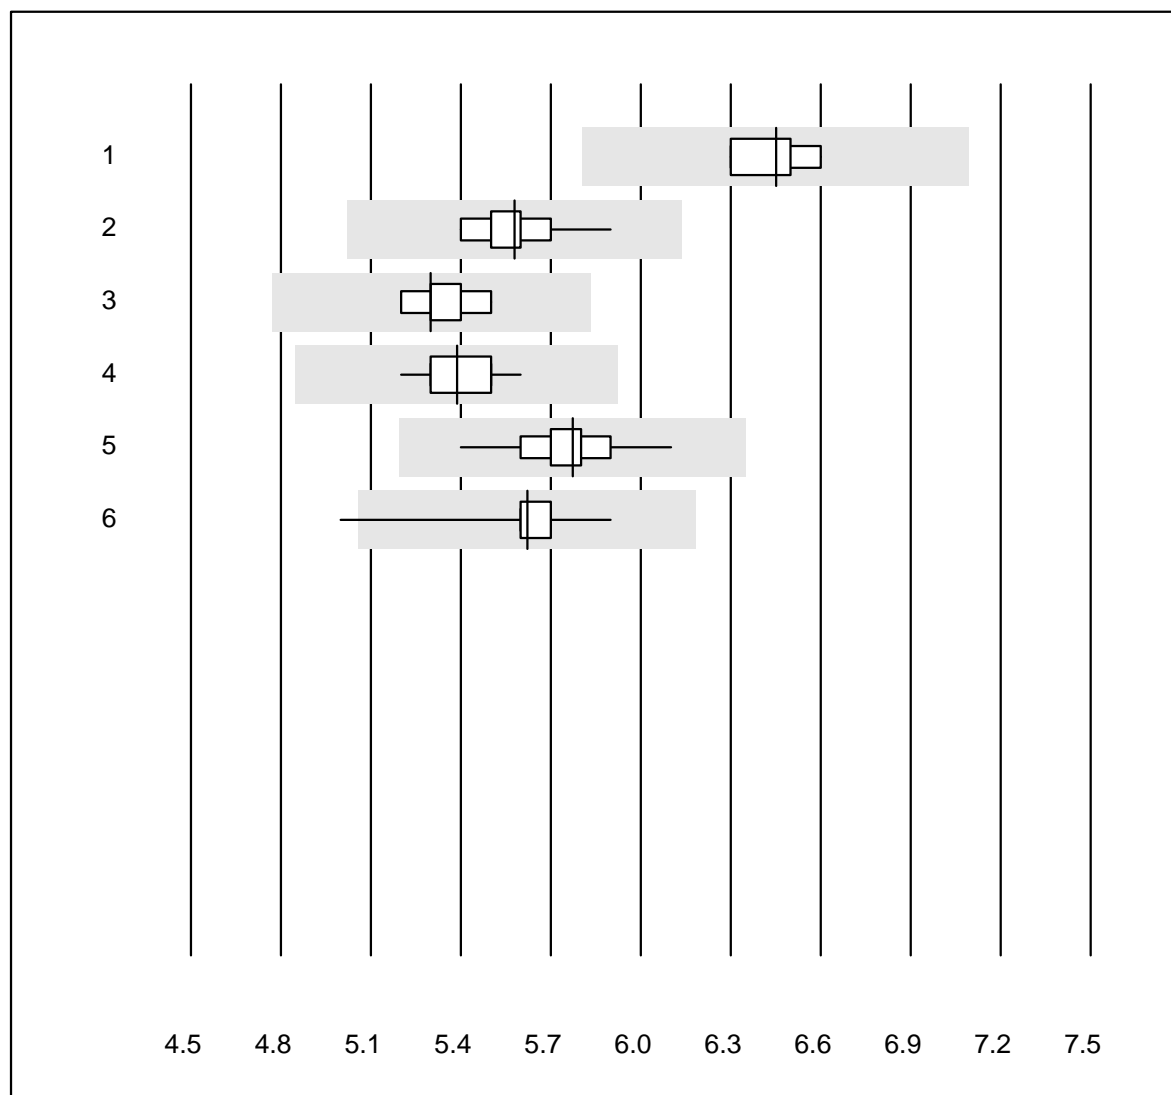


Tolérance QUALAB : 10 %

Glucose GS (mmol/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas b221	4	100.0	0.0	0.0	6.5	2.0	e
2 Cobas	10	100.0	0.0	0.0	5.6	2.6	e
3 iStat	9	100.0	0.0	0.0	5.3	1.6	e
4 EPOC	30	100.0	0.0	0.0	5.4	1.9	e
5 ABL700/800	65	96.9	0.0	3.1	5.8	2.2	e
6 ABL90 FLEX / PLUS	45	97.8	2.2	0.0	5.6	2.2	e

Hémoglobine BG

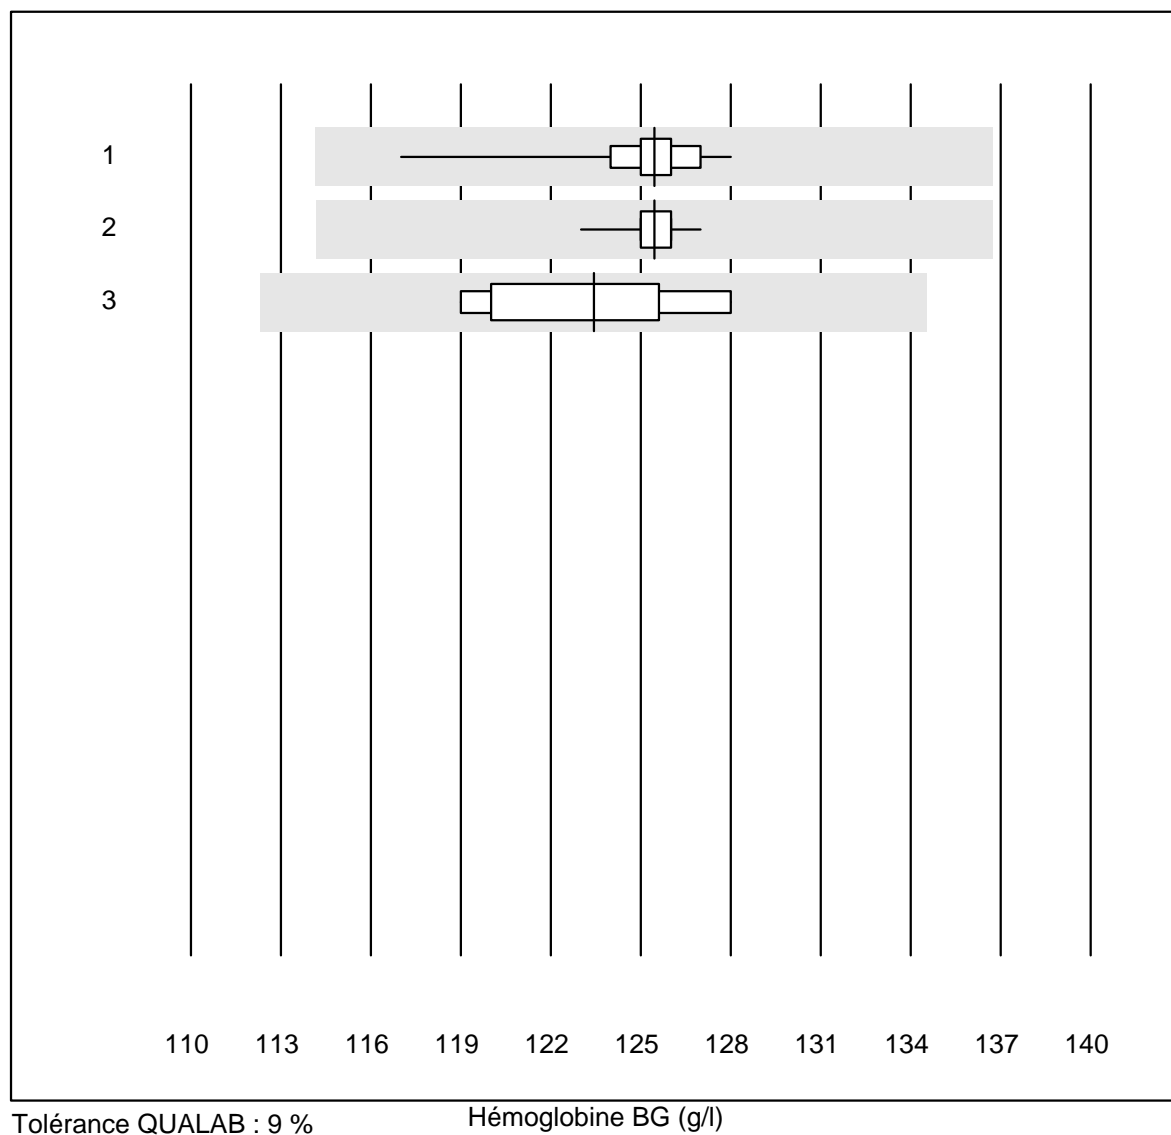

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	ABL700/800	66	98.5	0.0	1.5	125.5	1.5	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	45	95.6	0.0	4.4	125.5	0.6	e
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	13	100.0	0.0	0.0	123.4	2.7	e

Potassium BG

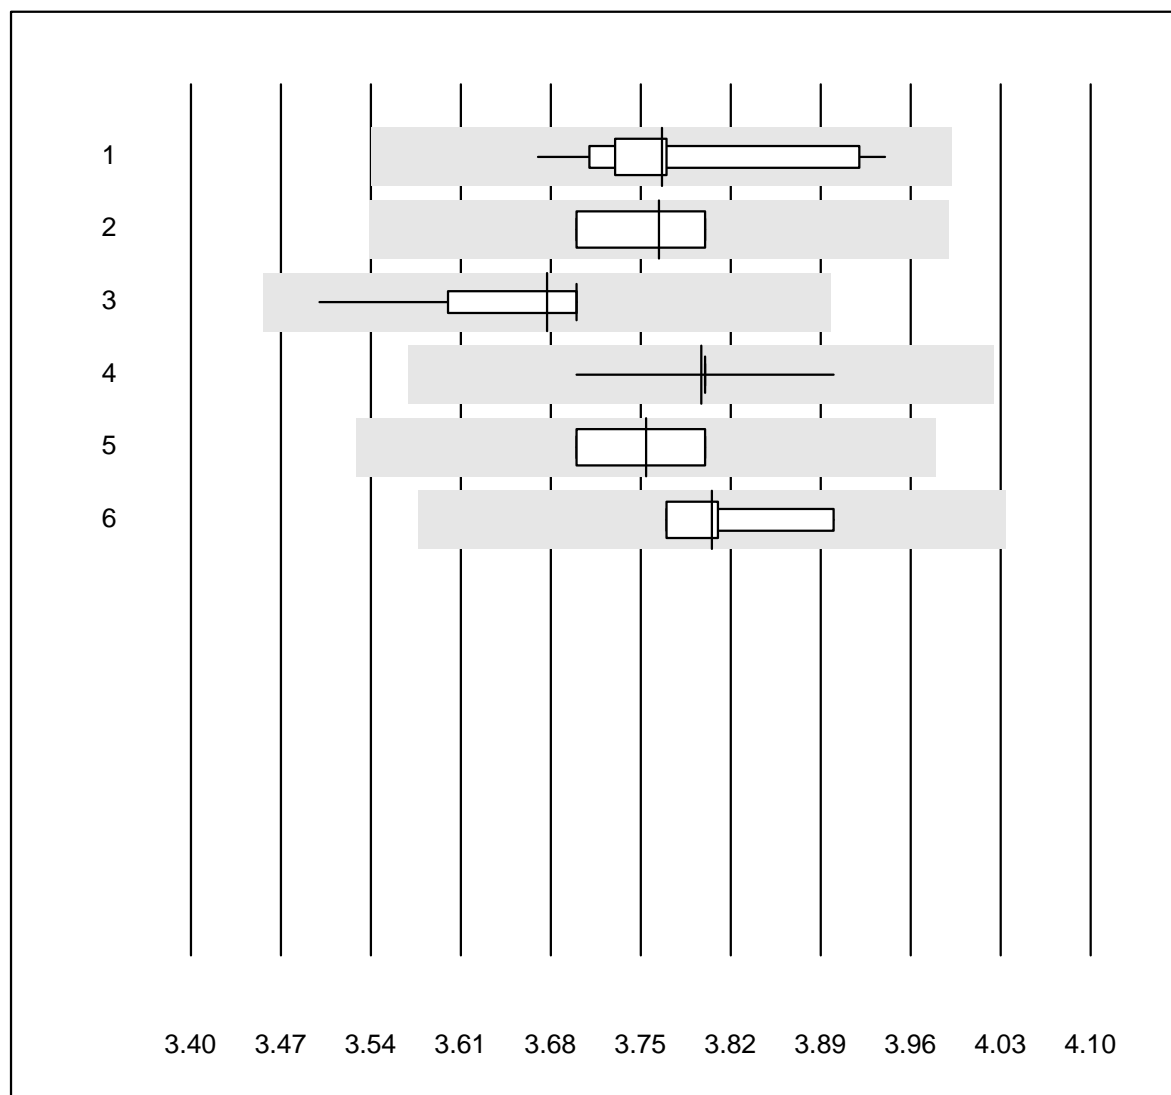


Tolérance QUALAB : 6 %

Potassium BG (mmol/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas	22	100.0	0.0	0.0	3.8	1.9	e
2	iStat	18	100.0	0.0	0.0	3.8	1.3	e
3	EPOC	35	100.0	0.0	0.0	3.7	1.3	e
4	ABL700/800	66	98.5	0.0	1.5	3.8	1.0	e
5	ABL90 FLEX / PLUS	46	100.0	0.0	0.0	3.8	1.3	e
6	ABL80 FLEX CO-OX / O	4	100.0	0.0	0.0	3.8	1.5	e*

Sodium BG

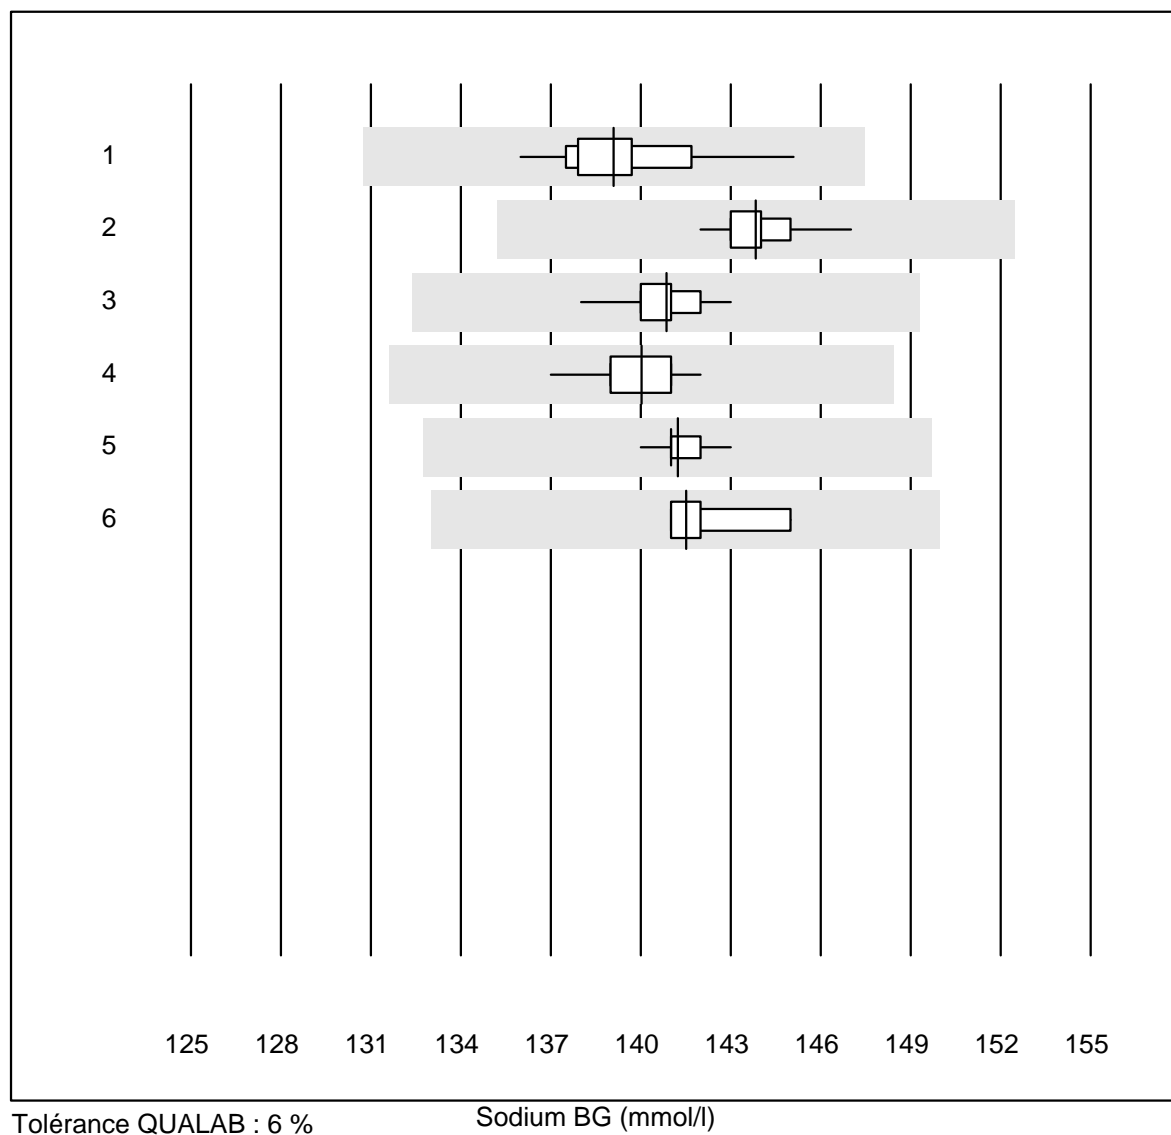


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas	22	100.0	0.0	0.0	139.1	1.6	e
2 iStat	18	100.0	0.0	0.0	143.8	0.8	e
3 EPOC	33	100.0	0.0	0.0	140.8	0.7	e
4 ABL700/800	64	100.0	0.0	0.0	140.0	0.7	e
5 ABL90 FLEX / PLUS	47	100.0	0.0	0.0	141.2	0.4	e
6 ABL80 FLEX CO-OX / O	4	100.0	0.0	0.0	141.5	1.3	e

Chlorure-BG

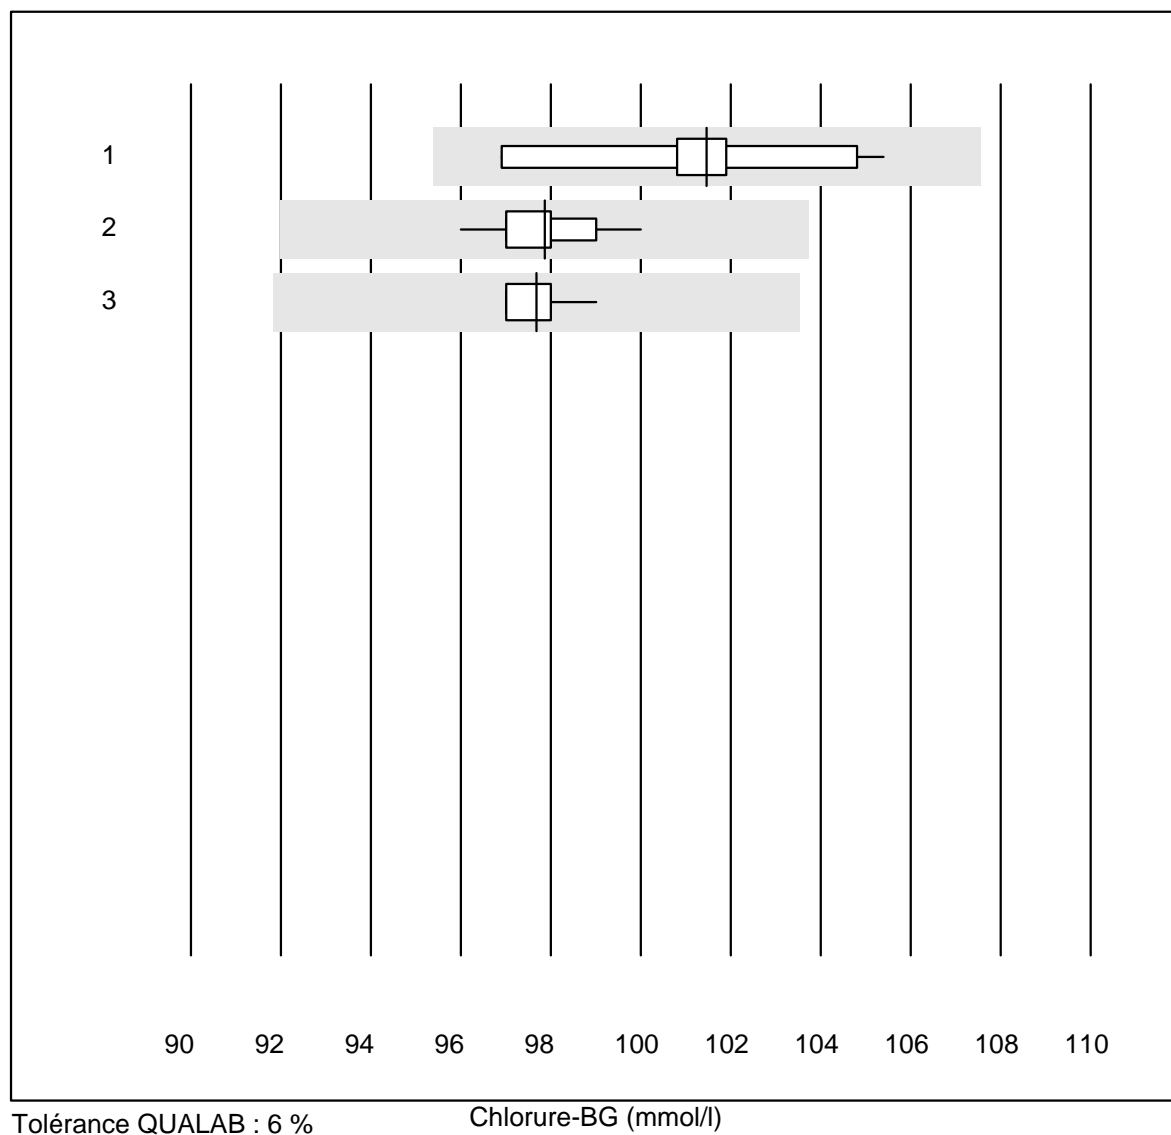

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas	10	100.0	0.0	0.0	101.5	2.3	e*
2 ABL700/800	57	100.0	0.0	0.0	97.9	1.0	e
3 ABL90 FLEX / PLUS	45	100.0	0.0	0.0	97.7	0.5	e

Calcium-BG

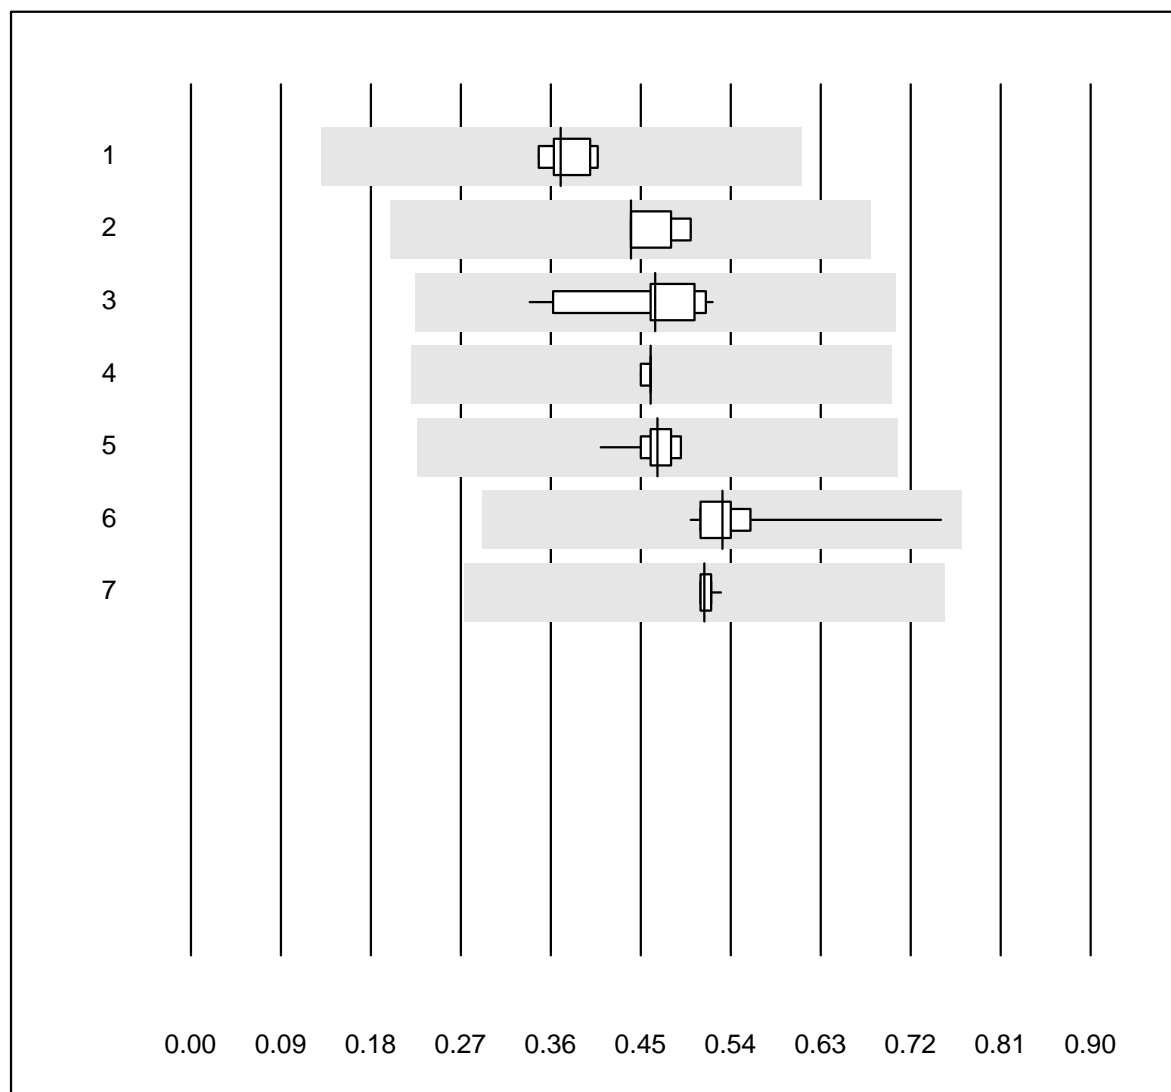


Tolérance MQ : 12 %
(< 2.00: +/- 0.24 mmol/l)

Calcium-BG (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas b123	7	100.0	0.0	0.0	0.37	5.6	e*
2	ABL80 FLEX	4	100.0	0.0	0.0	0.44	6.5	e*
3	Cobas	14	100.0	0.0	0.0	0.46	11.5	e*
4	iStat	9	100.0	0.0	0.0	0.46	1.0	e
5	EPOC	32	100.0	0.0	0.0	0.47	3.7	e
6	ABL700/800	65	98.5	0.0	1.5	0.53	6.6	e
7	ABL90 FLEX / PLUS	47	100.0	0.0	0.0	0.51	1.0	e

FHHb

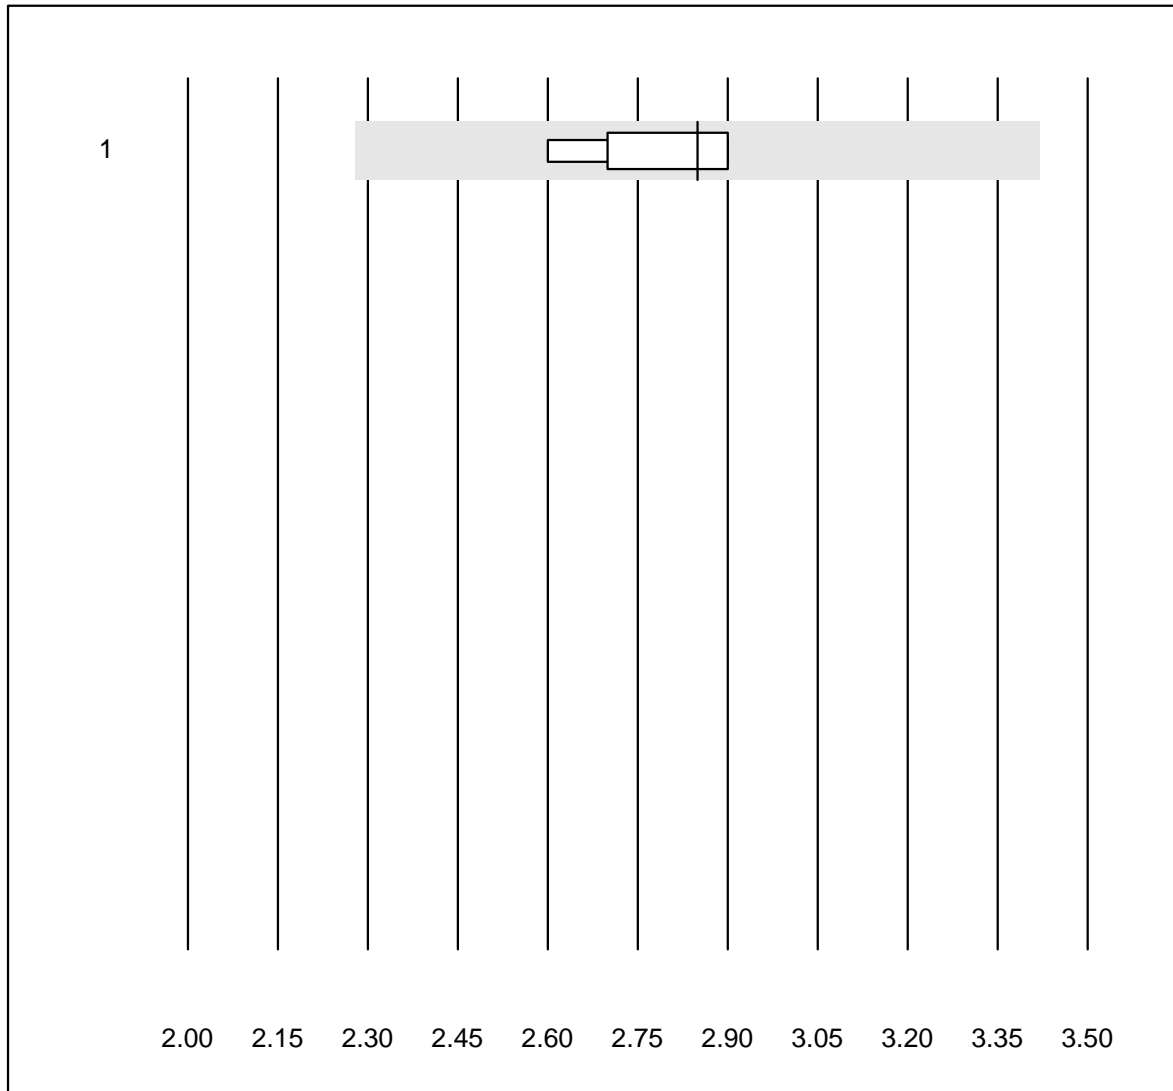


Tolérance MQ : 20 %

FHHb (%)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	ABL80 FLEX CO-OX / O	6	100.0	0.0	0.0	2.850	4.5	e

Lactate-BG

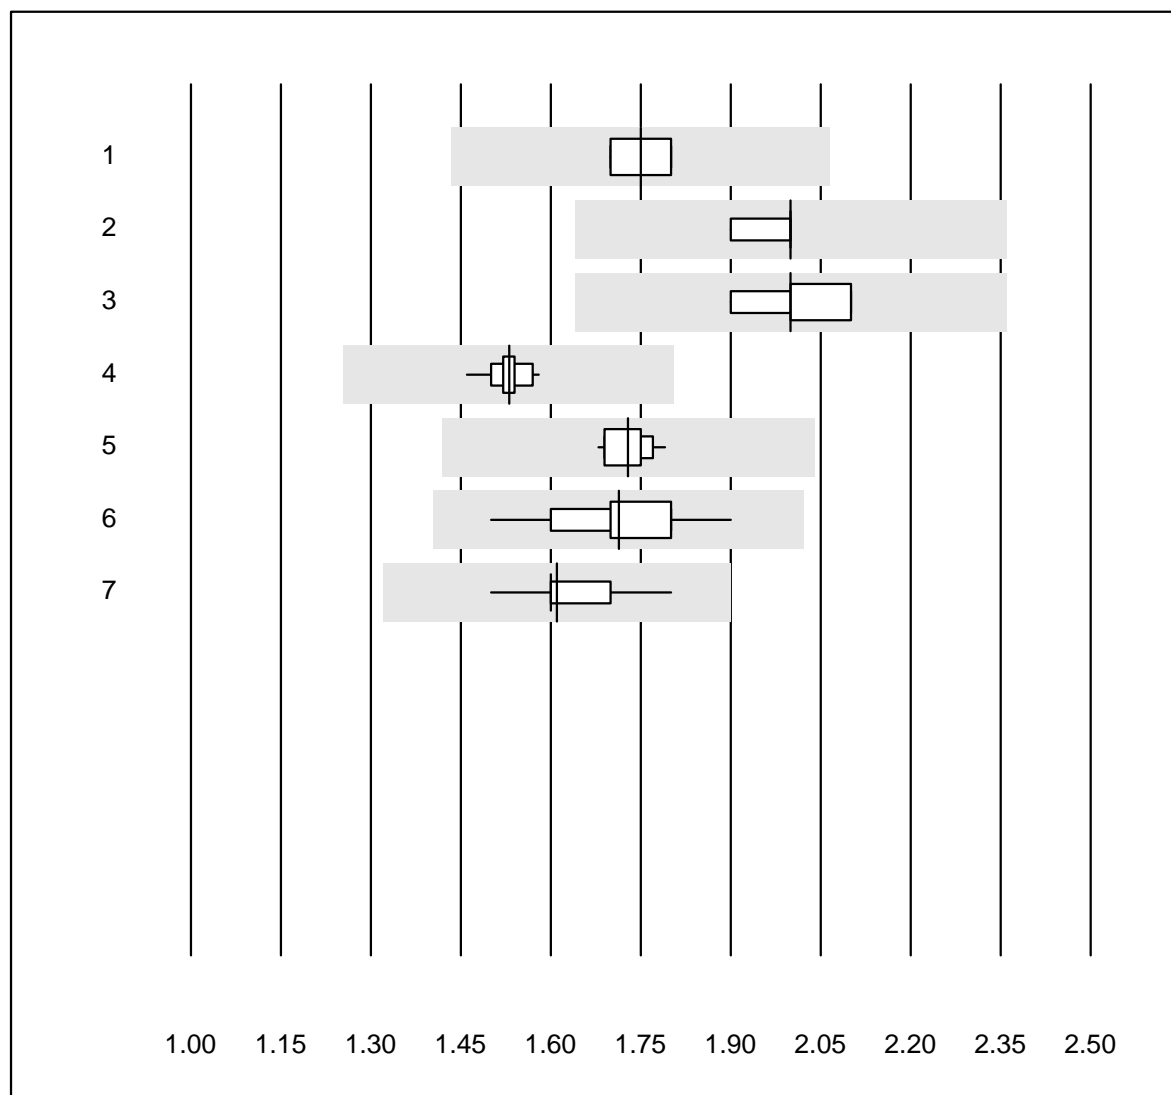


Tolérance QUALAB : 18 %

Lactate-BG (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	GEM	4	100.0	0.0	0.0	1.75	3.3	e
2	Cobas b123	7	100.0	0.0	0.0	2.00	1.9	e
3	Cobas	6	100.0	0.0	0.0	2.00	3.7	e
4	EPOC	37	100.0	0.0	0.0	1.53	1.7	e
5	iStat	11	100.0	0.0	0.0	1.73	2.0	e
6	ABL700/800	69	95.7	0.0	4.3	1.71	4.1	e
7	ABL90 FLEX / PLUS	47	100.0	0.0	0.0	1.61	3.0	e

sO2 OR

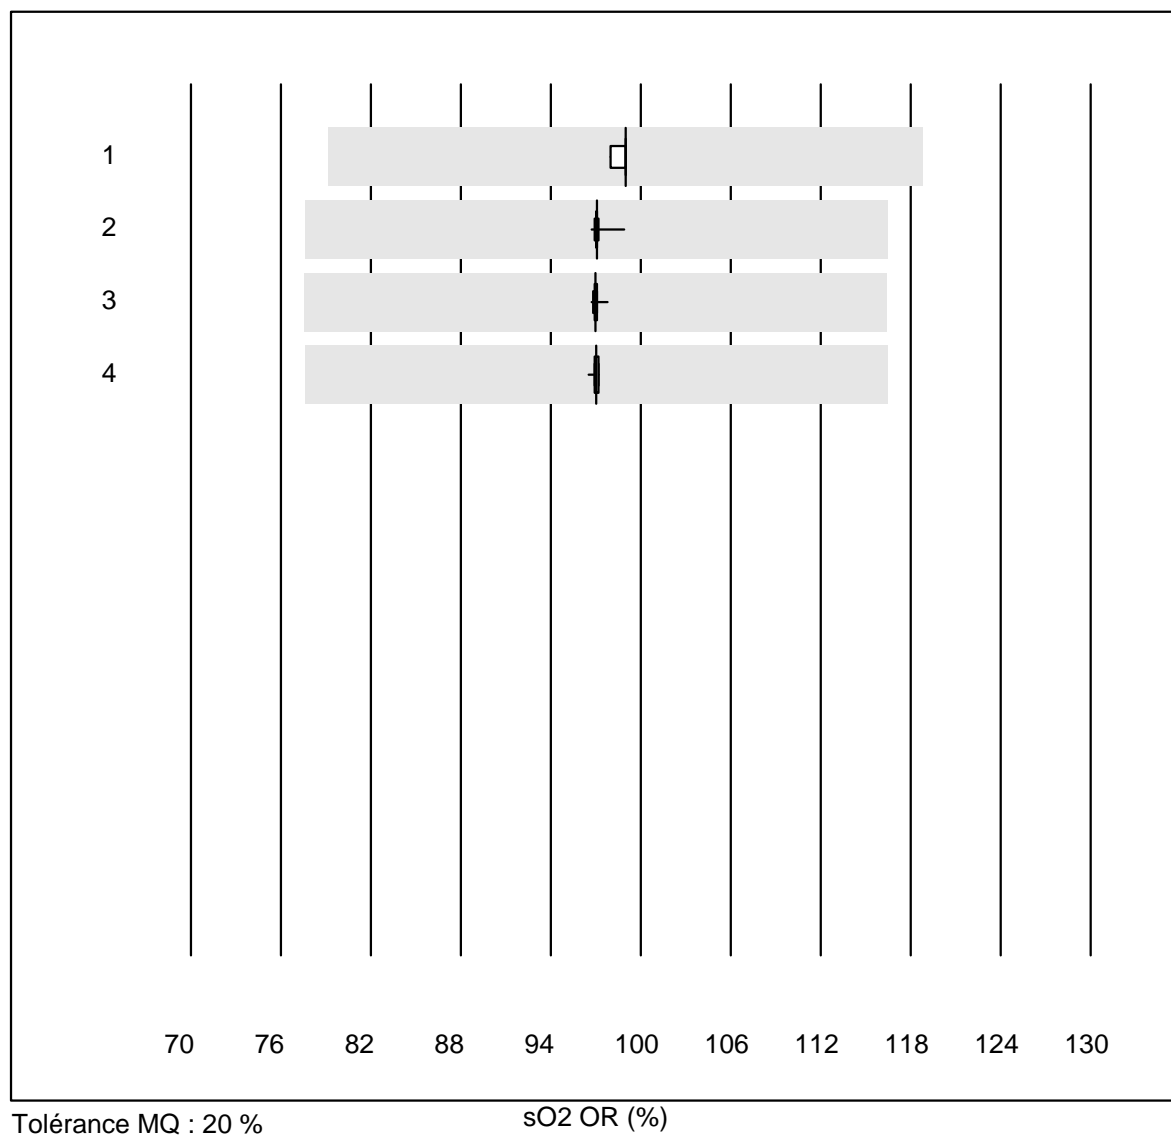


Tolérance MQ : 20 %

sO2 OR (%)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 iStat	9	100.0	0.0	0.0	99.000	0.4	e
2 ABL700/800	52	100.0	0.0	0.0	97.065	0.3	e
3 ABL90 FLEX / PLUS	41	100.0	0.0	0.0	96.981	0.2	e
4 ABL80 FLEX CO-OX / O	11	100.0	0.0	0.0	97.018	0.2	e

FO2Hb OR

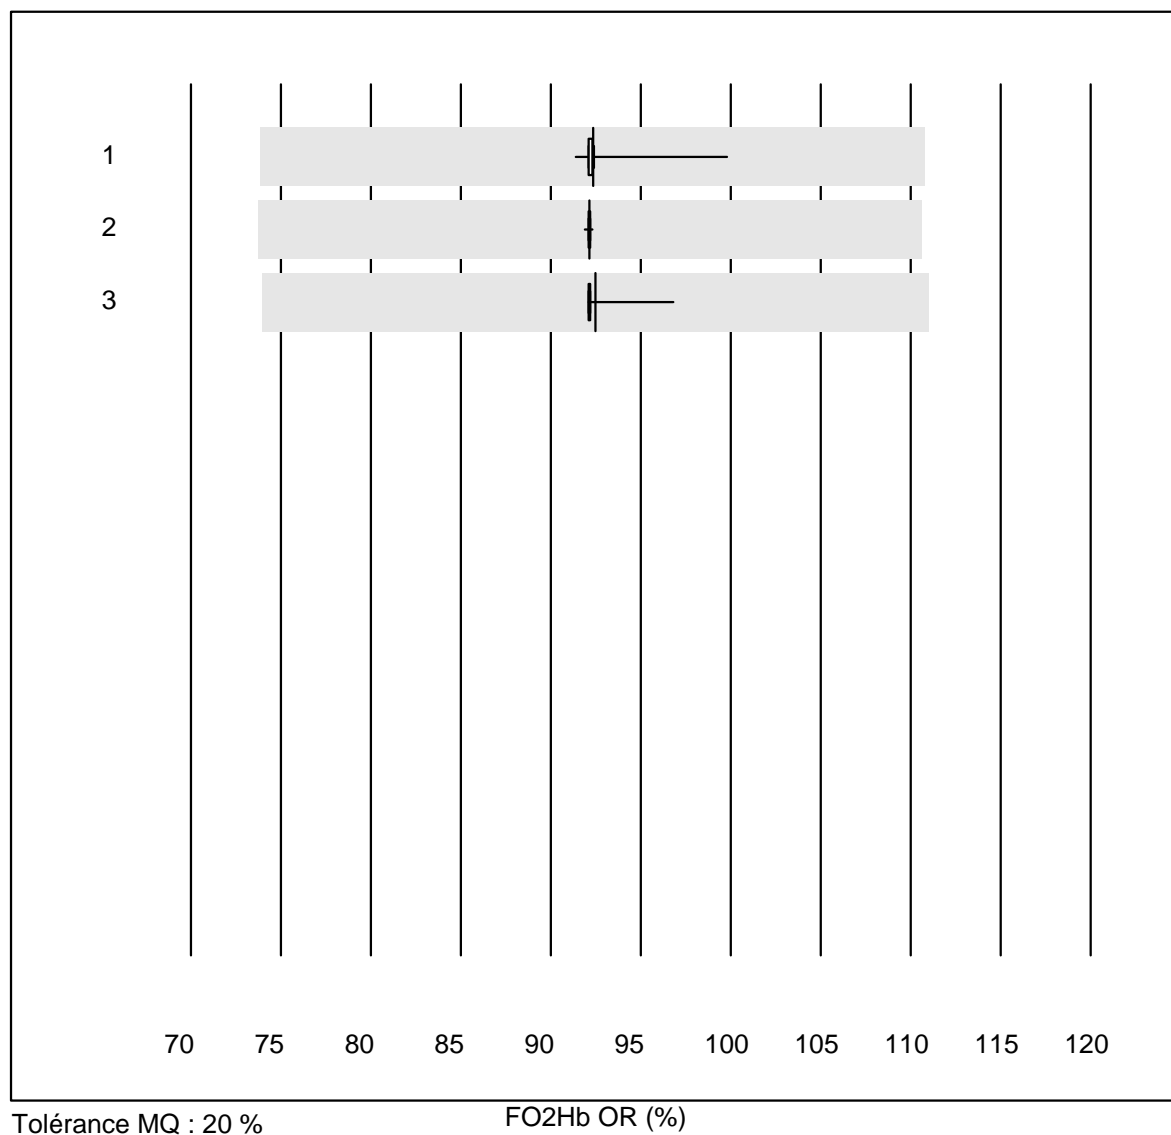


Tolérance MQ : 20 %

FO2Hb OR (%)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	ABL700/800	47	100.0	0.0	0.0	92.343	1.2	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	44	100.0	0.0	0.0	92.159	0.1	e
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	14	100.0	0.0	0.0	92.493	1.3	e

FCOHb OR

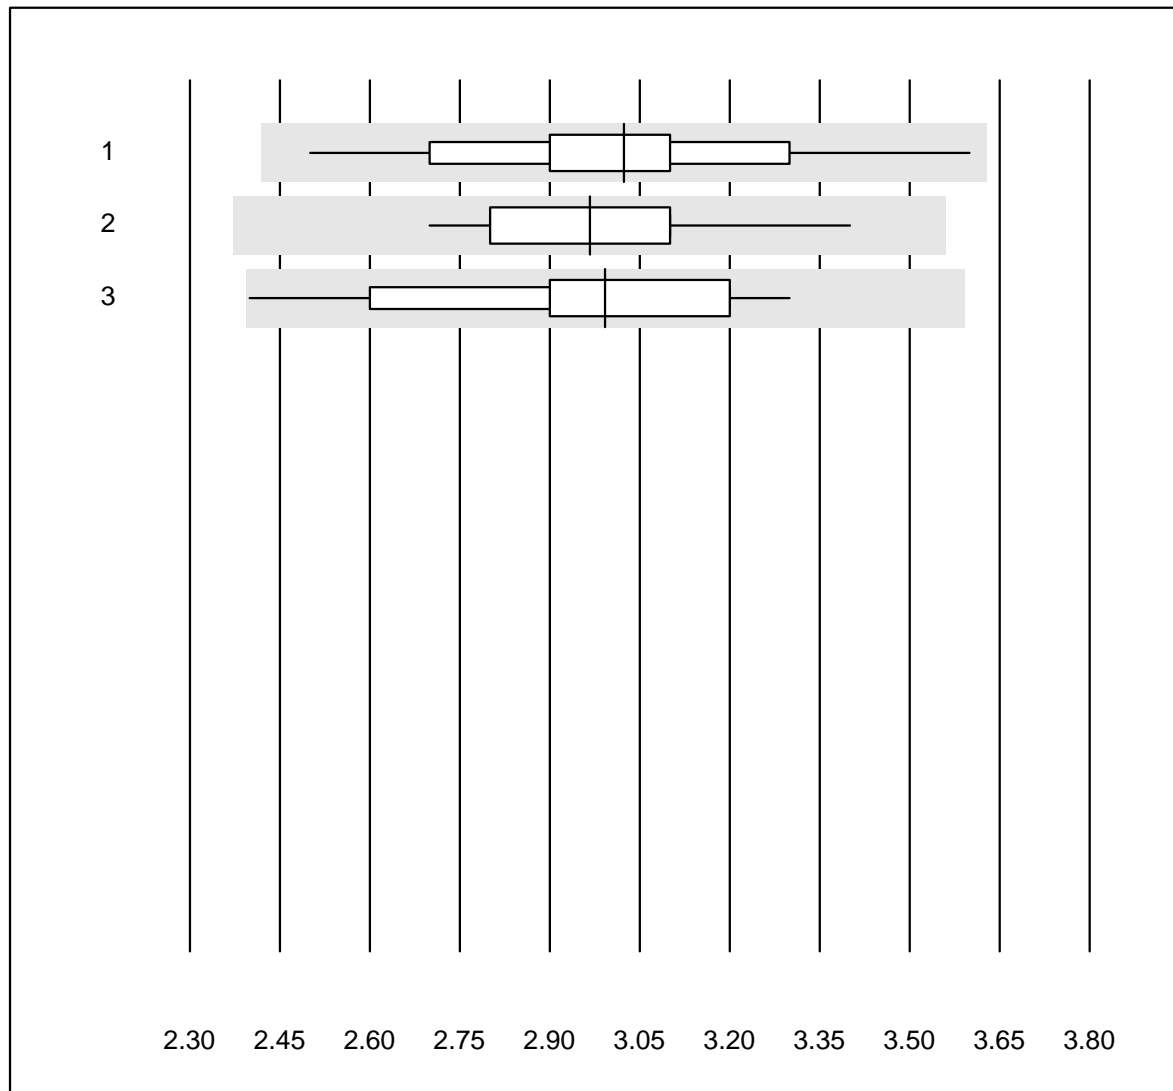


Tolérance MQ : 20 %

FCOHb OR (%)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ABL700/800	48	100.0	0.0	0.0	3.023	7.0	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	43	97.7	0.0	2.3	2.967	5.0	e
3 ABL80 FLEX CO-OX / O	14	92.9	0.0	7.1	2.992	8.7	e

FMetHb OR

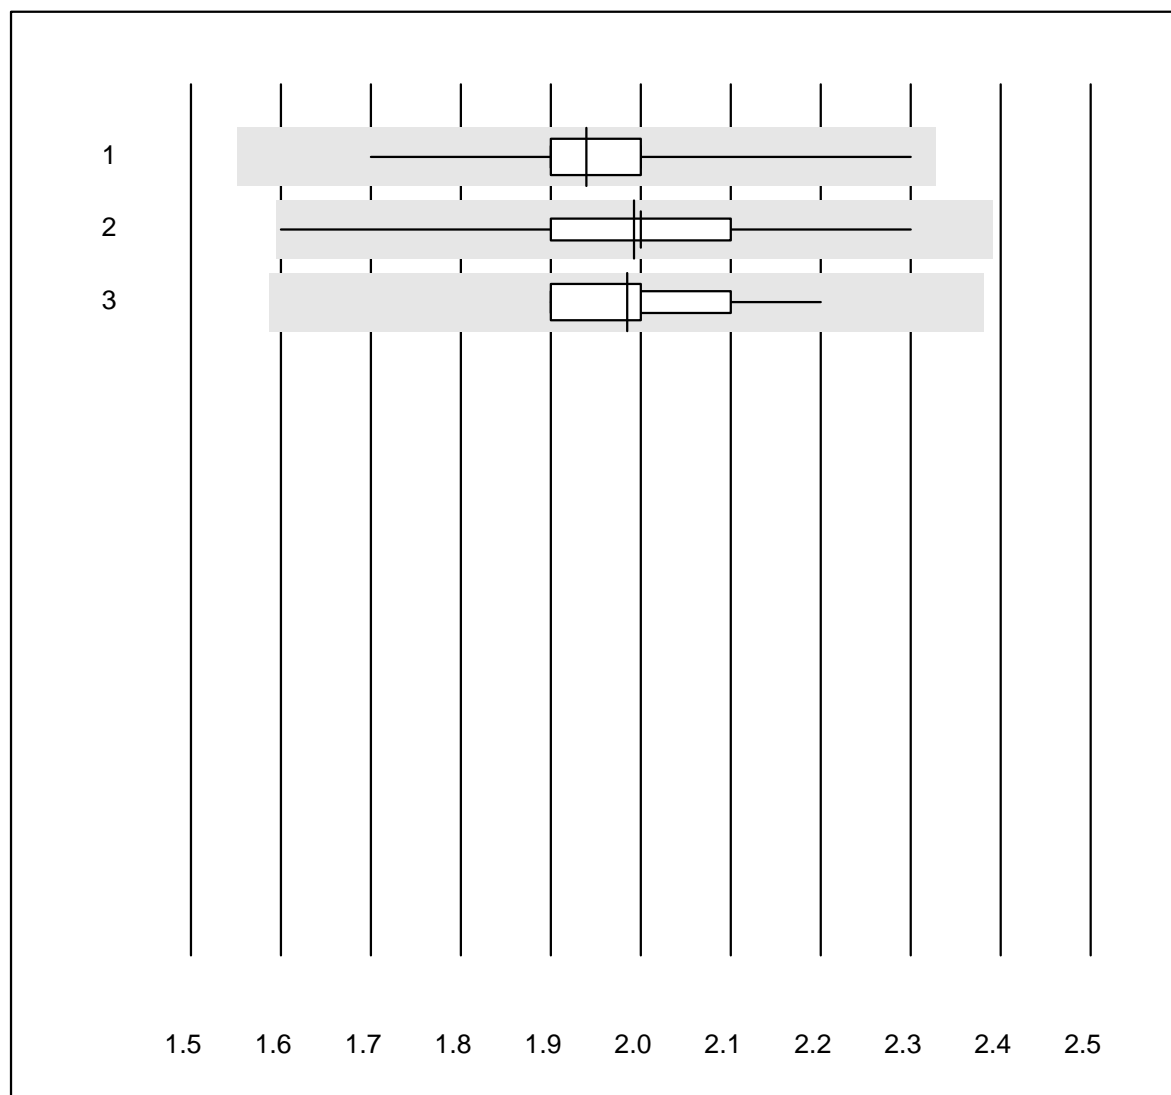


Tolérance MQ : 20 %

FMetHb OR (%)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ABL700/800	55	96.4	0.0	3.6	1.940	5.0	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	39	100.0	0.0	0.0	1.992	4.8	e
3 ABL80 FLEX CO-OX / O	14	92.9	0.0	7.1	1.985	4.5	e

FHbF OR

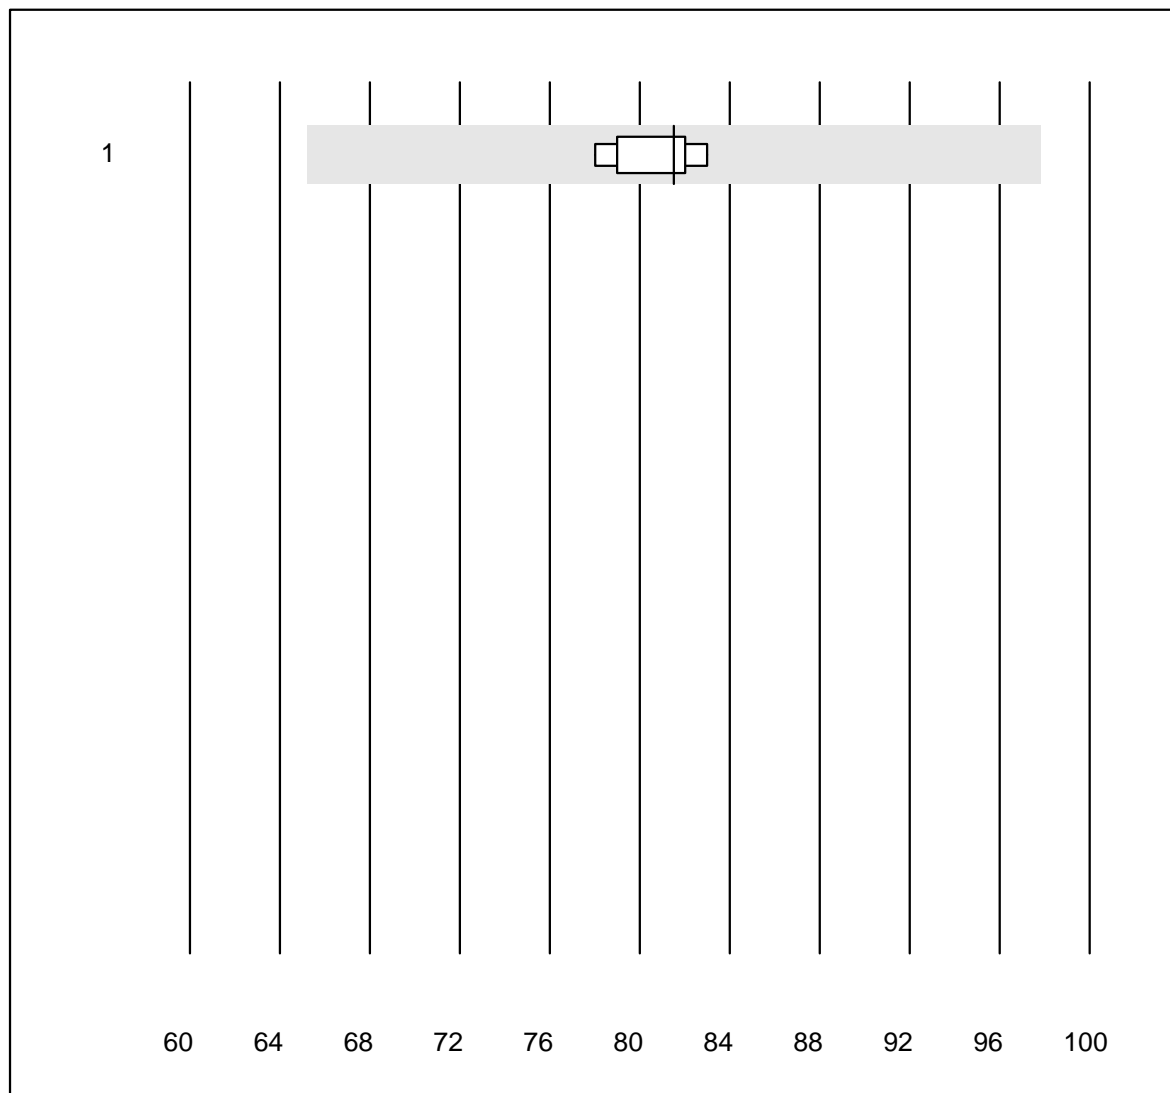


Tolérance MQ : 20 %

FHbF OR (%)

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ABL90 FLEX / PLUS	8	100.0	0.0	0.0	81.500	2.2	e

Bilirubin OR

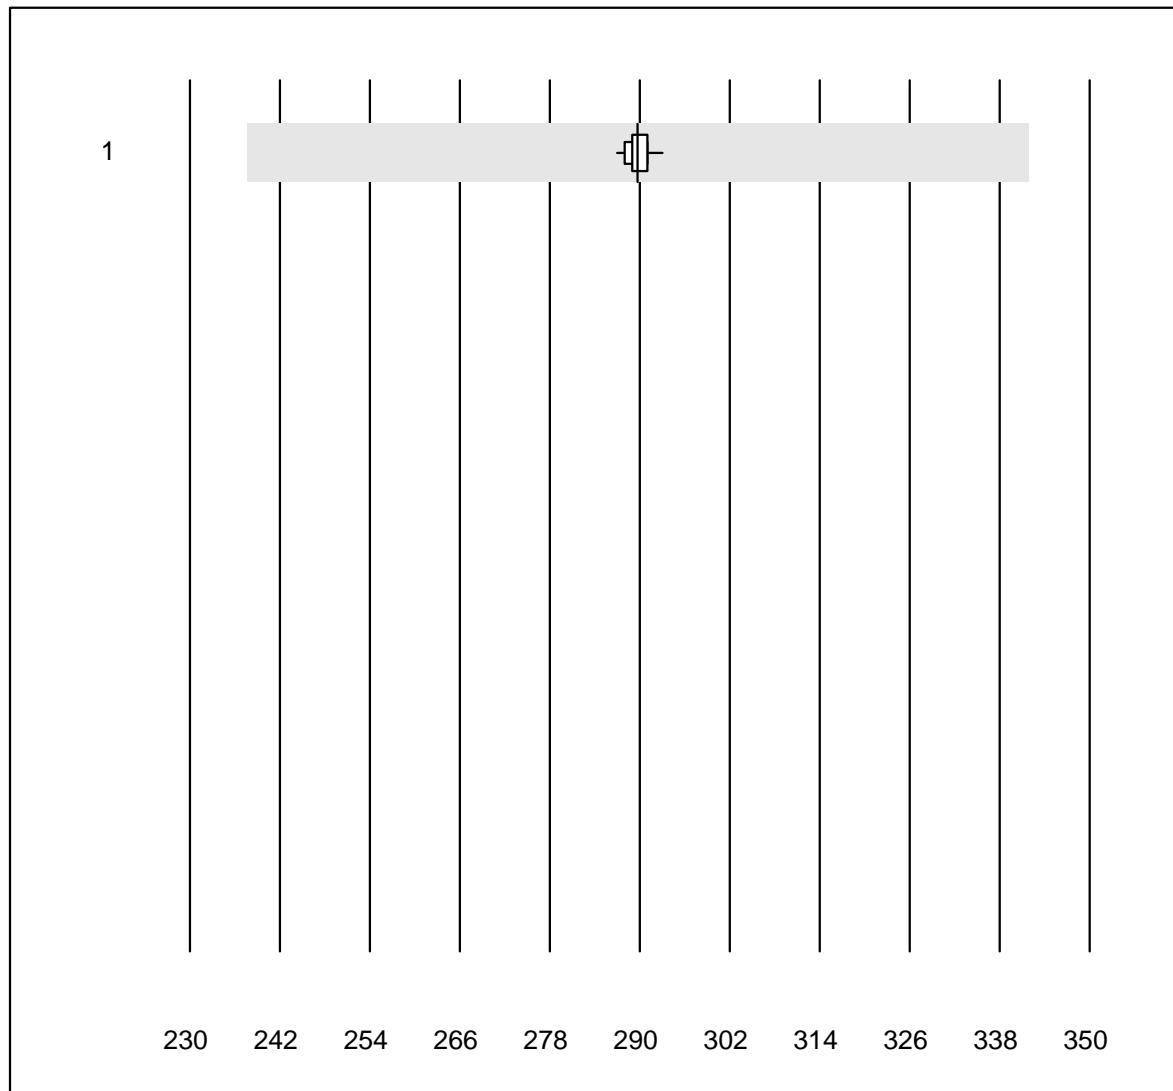


Tolérance QUALAB : 18 %

Bilirubin OR ($\mu\text{mol/l}$)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ABL90 FLEX / PLUS	14	100.0	0.0	0.0	289.7	0.5	e

Troponine I

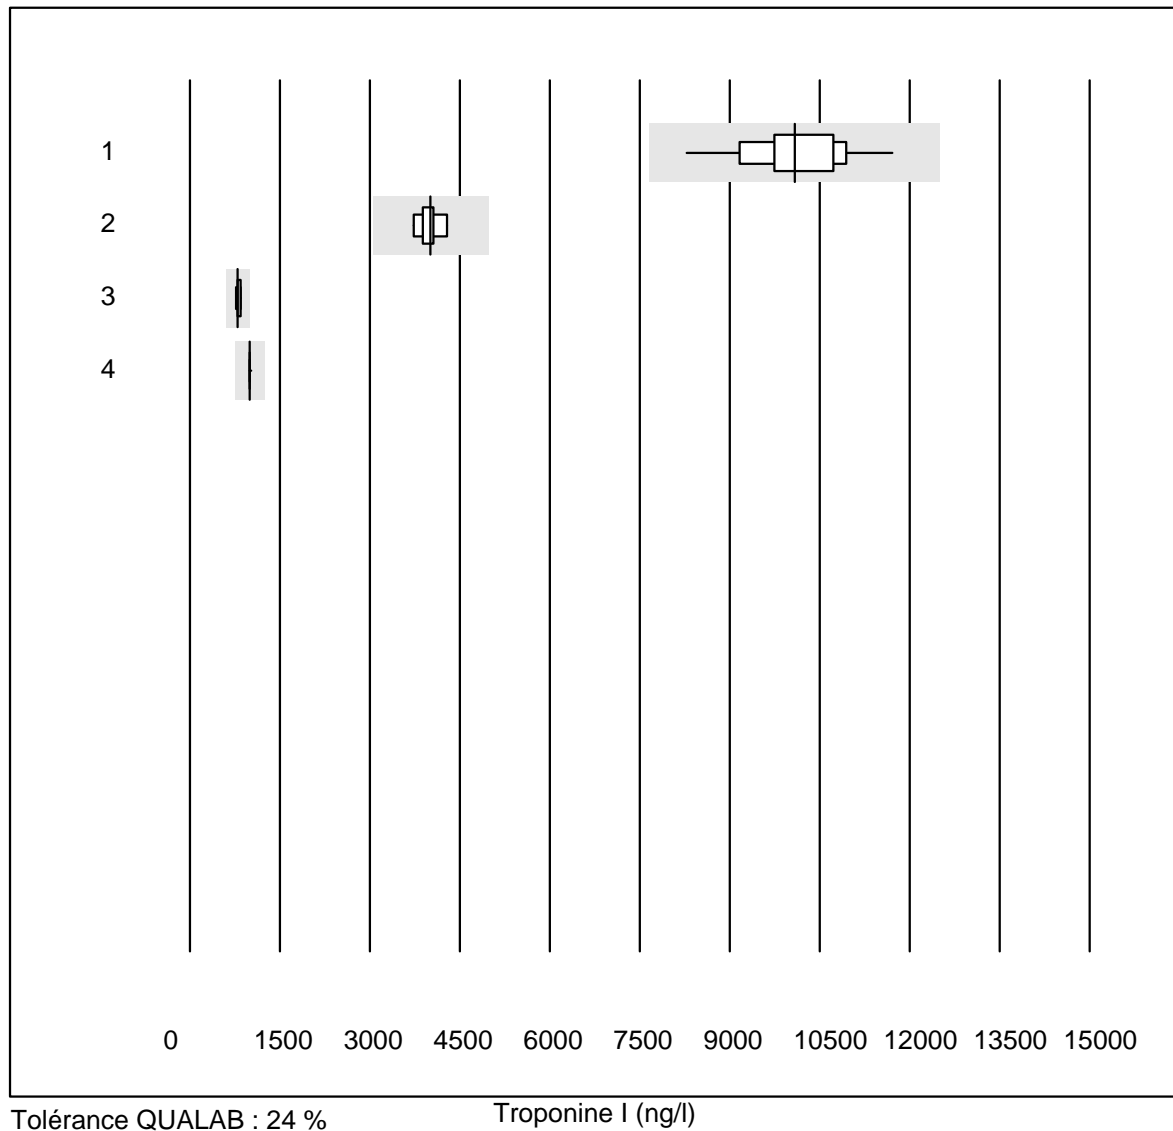


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Vidas	15	100.0	0.0	0.0	10080.4	8.3	e
2	Architect High Sensi	9	100.0	0.0	0.0	4013.0	4.1	e
3	AQT 90 FLEX	7	100.0	0.0	0.0	800.0	3.3	e
4	Eurolyser	11	100.0	0.0	0.0	1001.8	0.6	e

Troponine T

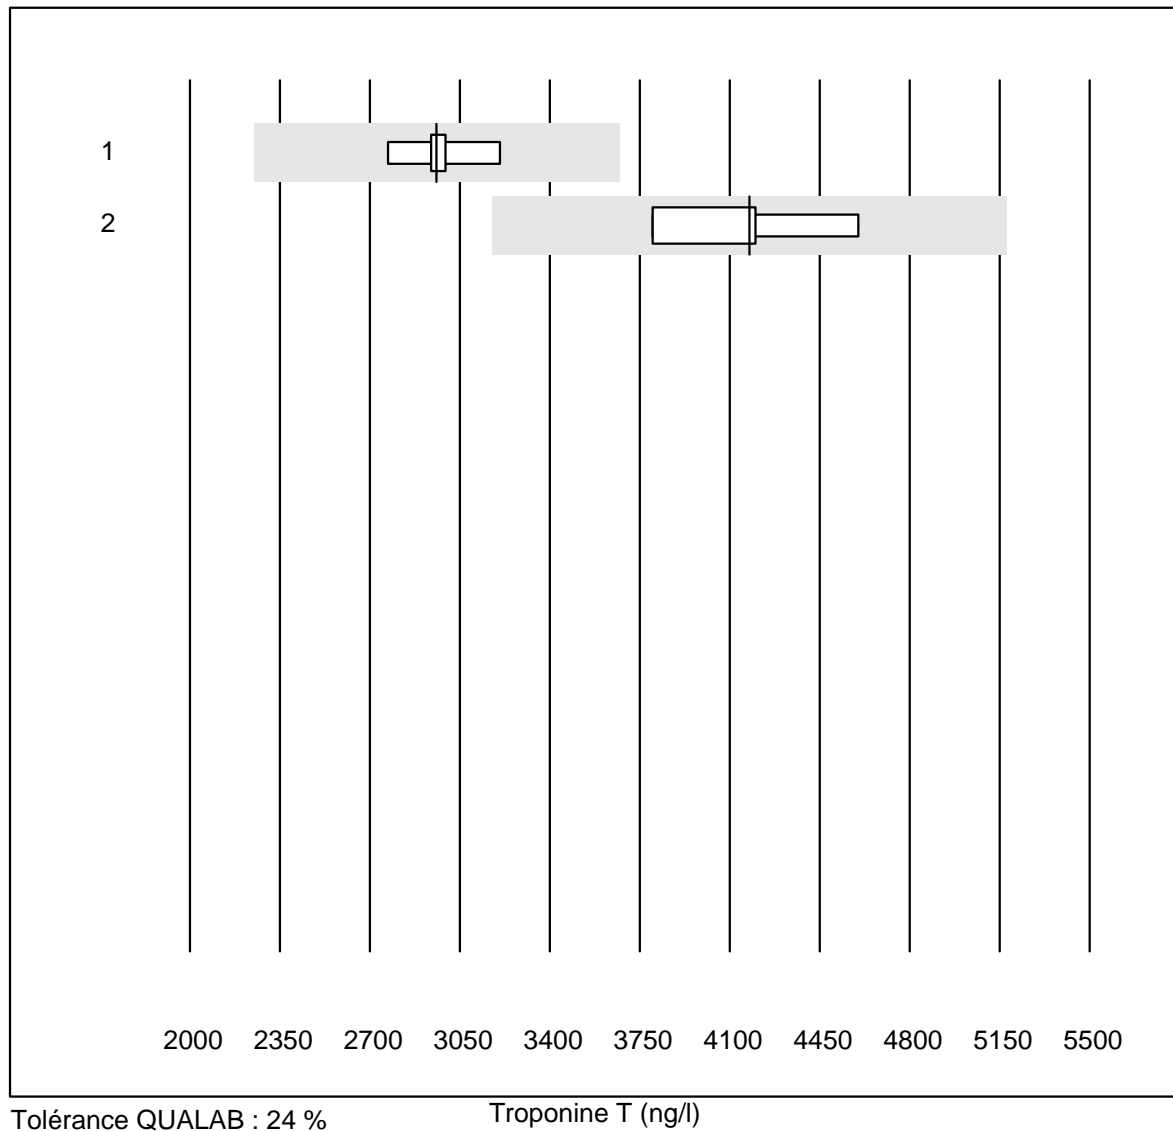


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas hs STAT	7	100.0	0.0	0.0	2960.00	4.3	e
2	AQT 90 FLEX	4	100.0	0.0	0.0	4175.00	7.8	e*

Myoglobine

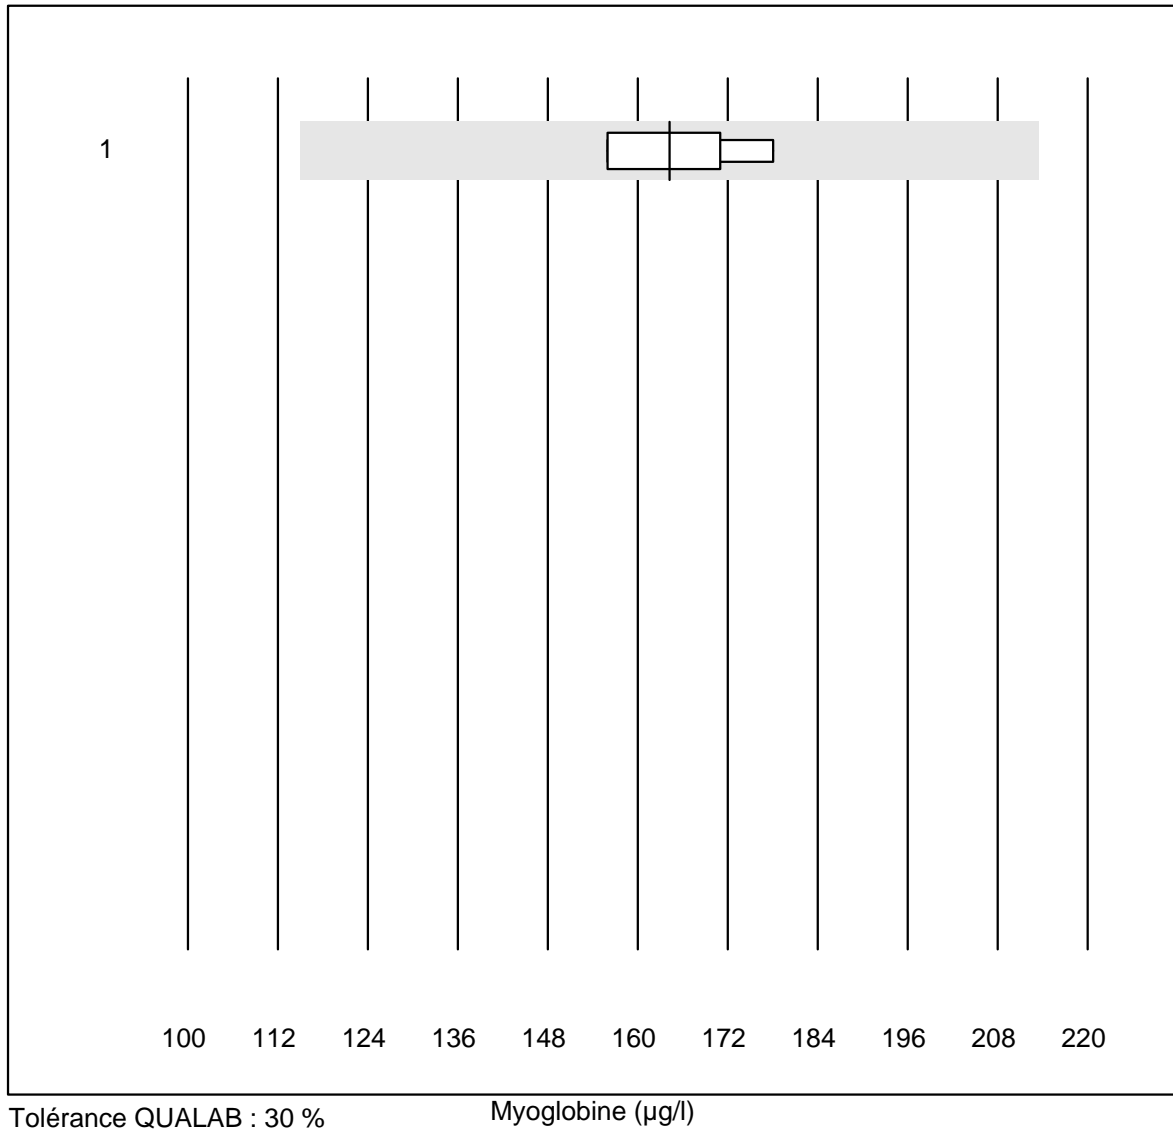


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	4	100.0	0.0	0.0	164.2	6.5	e

masse CK-MB

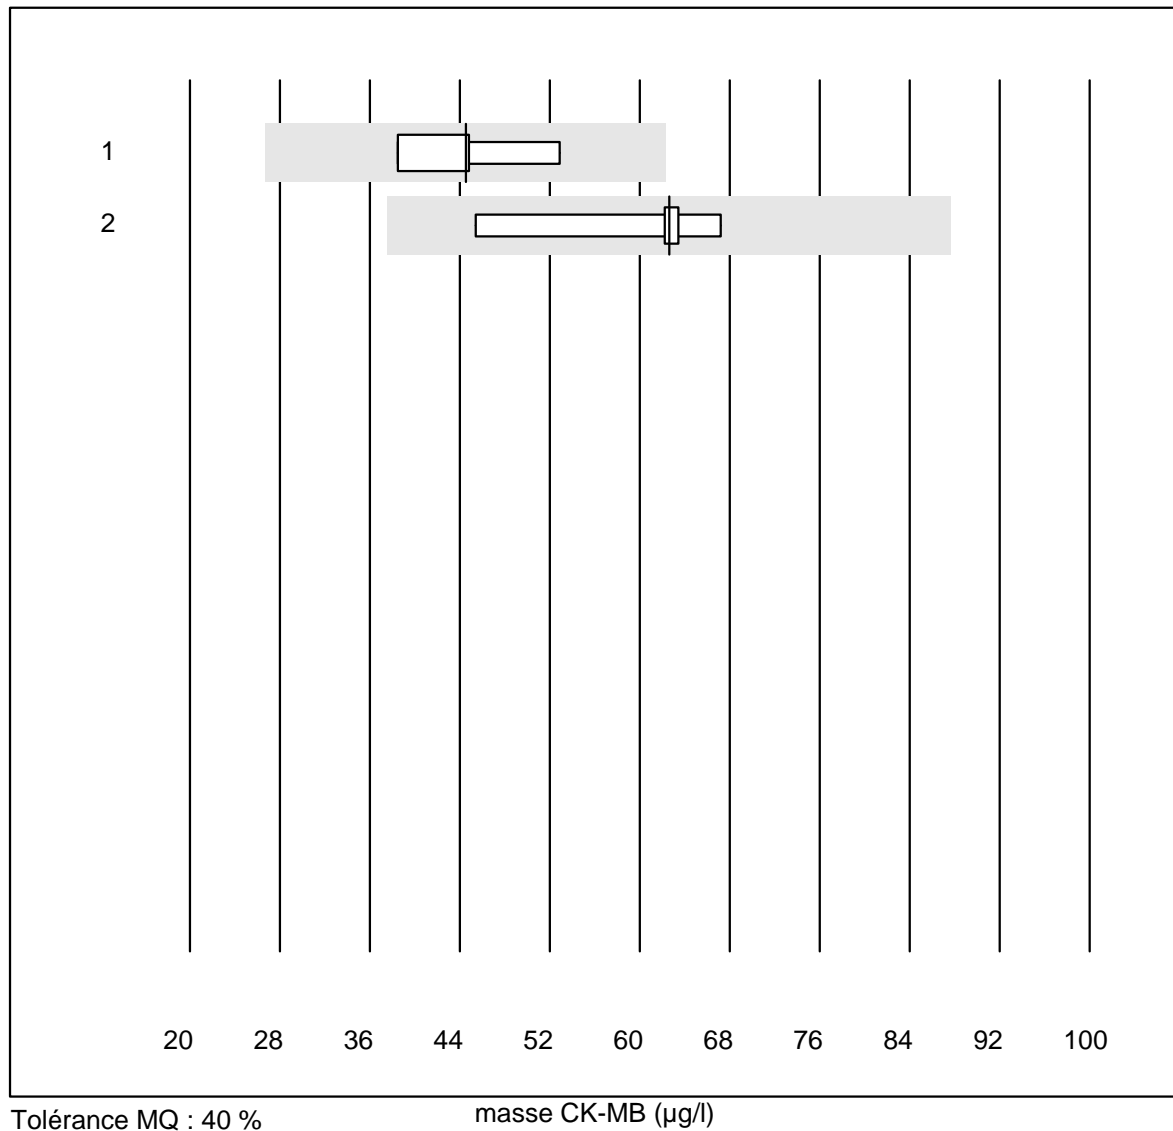

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Architect	4	100.0	0.0	0.0	44.6	13.2	e*
2 VIDAS	6	100.0	0.0	0.0	62.6	12.7	e*

TSH

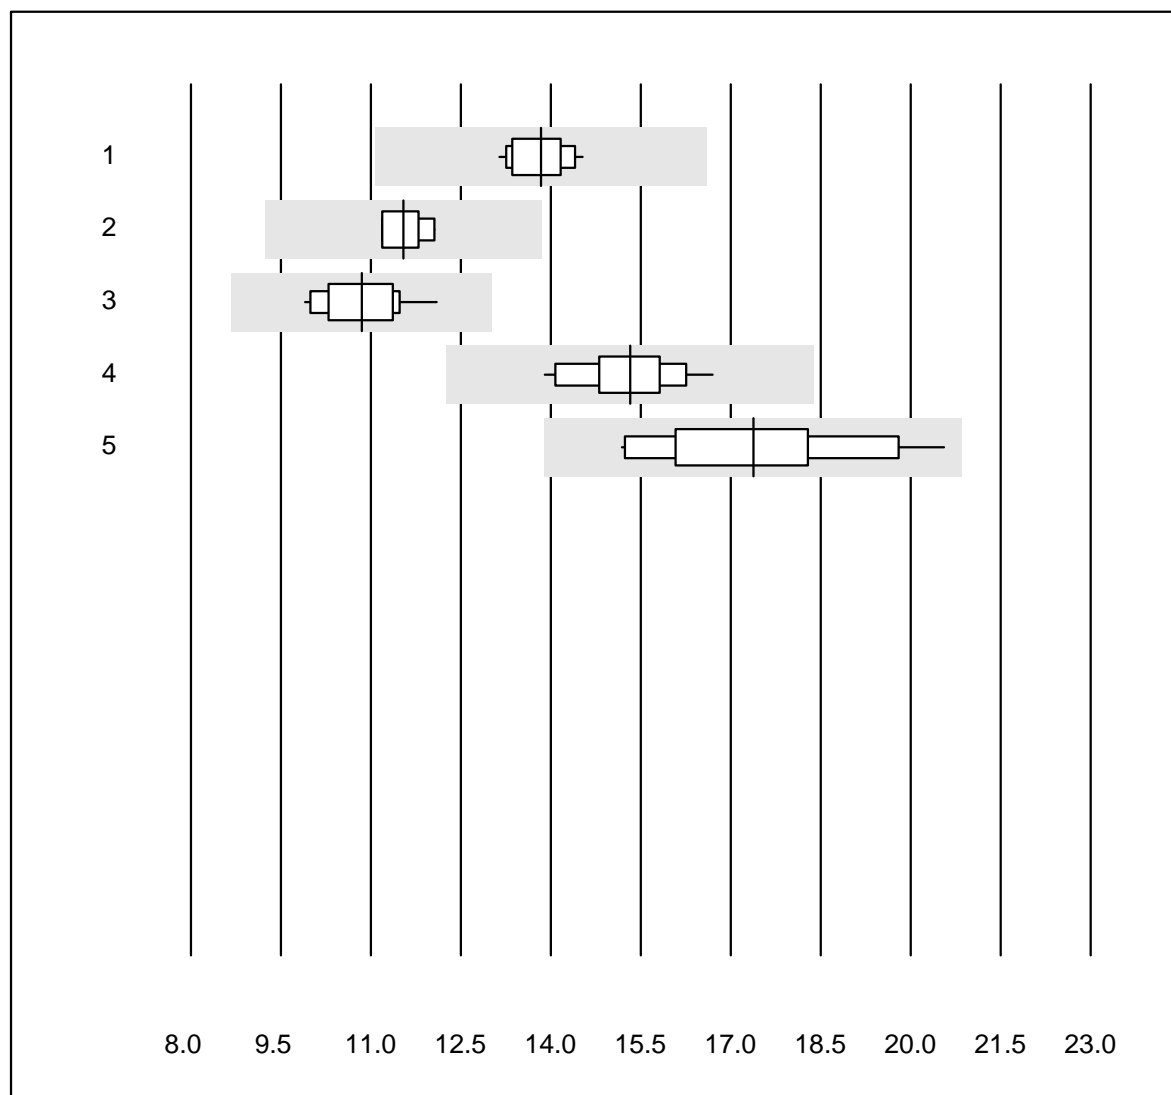


Tolérance QUALAB : 20 %

TSH (mU/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	12	100.0	0.0	0.0	13.83	3.2	e
2 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	11.54	3.6	e
3 Architect	11	100.0	0.0	0.0	10.85	6.3	e
4 VIDAS	14	100.0	0.0	0.0	15.32	5.4	e
5 AFIAS	18	100.0	0.0	0.0	17.38	9.0	e


T3

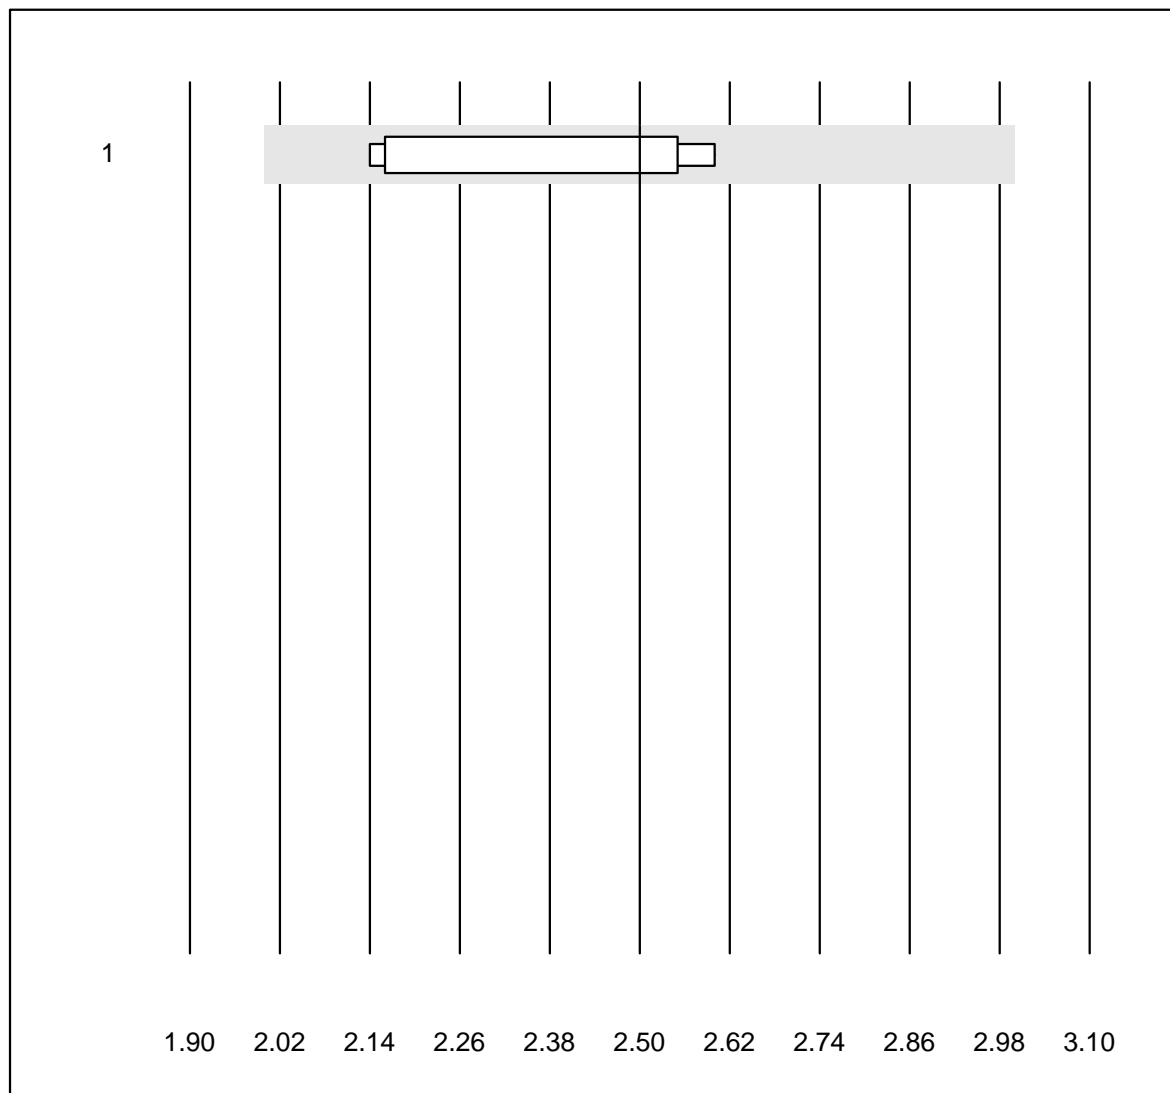

Tolérance MQ : 20 %


T3 (nmol/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 AFIAS	7	100.0	0.0	0.0	2.5	8.8	e*

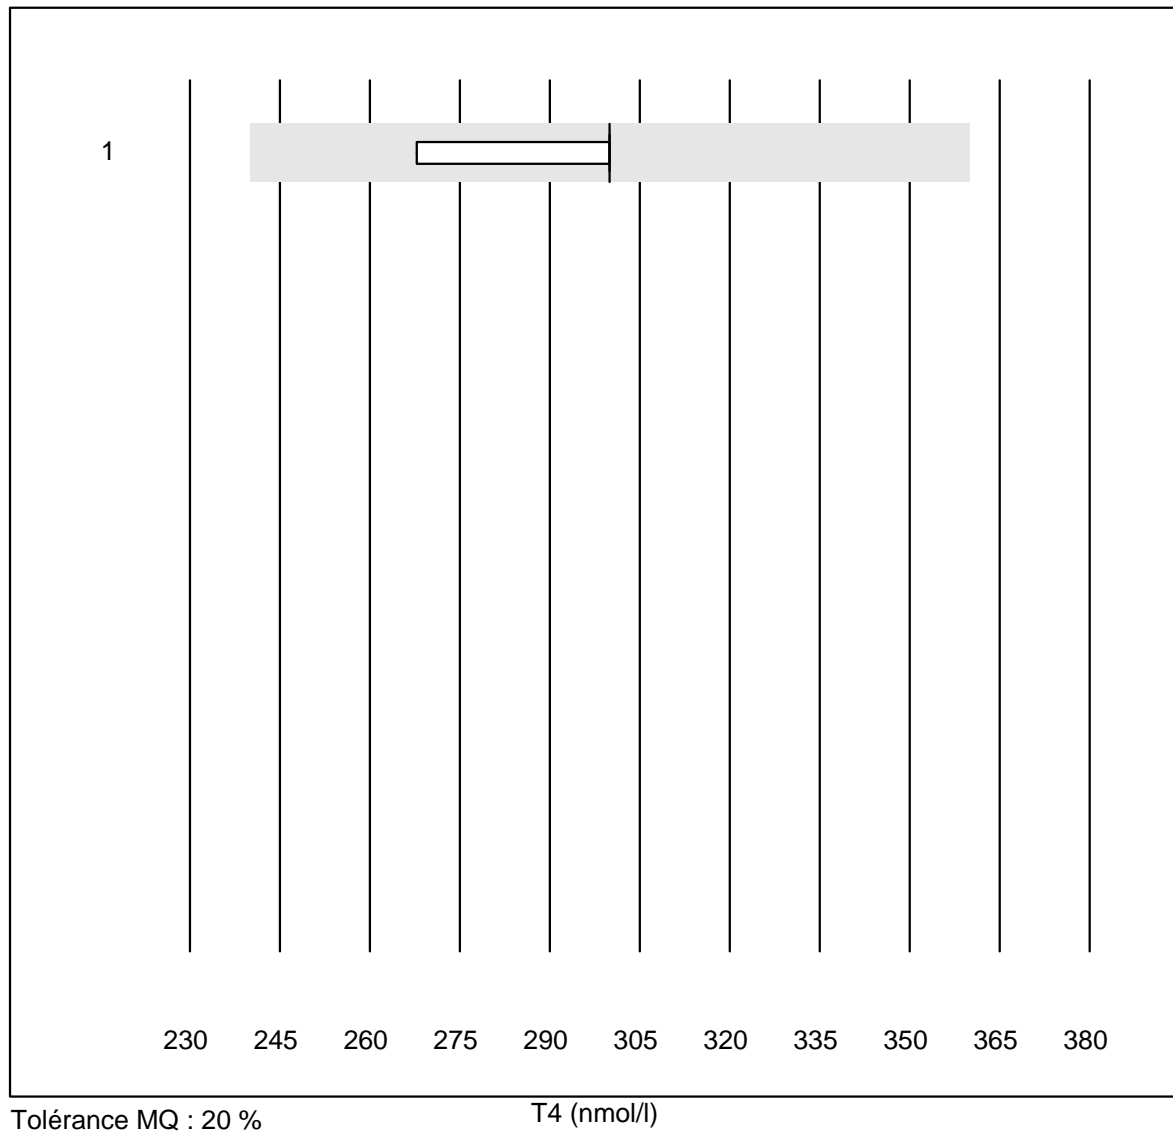
T4

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 AFIAS	8	100.0	0.0	0.0	300	3.8	e

FT3

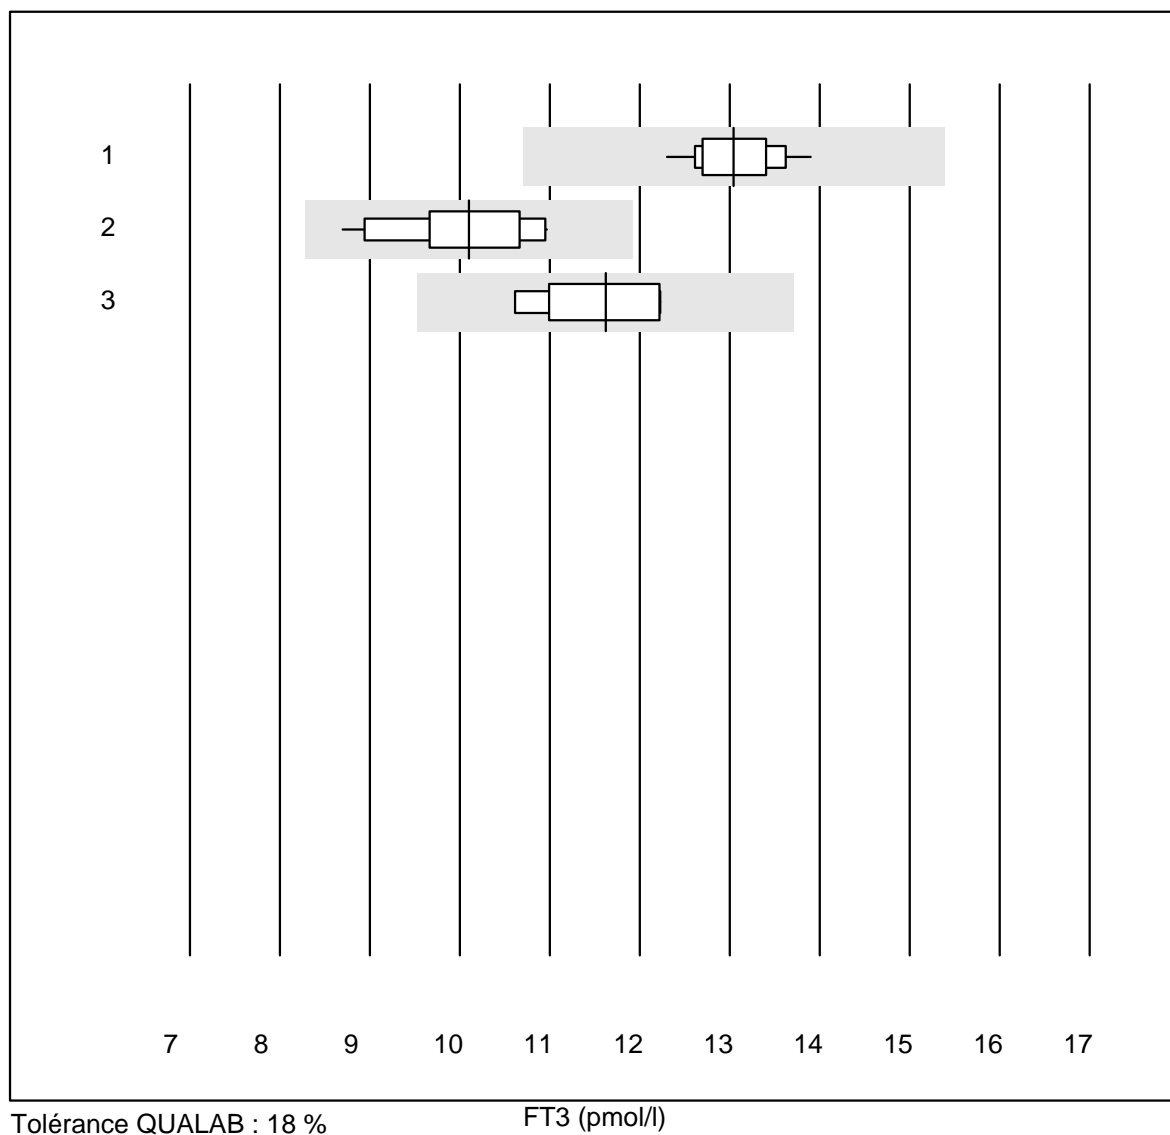


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	12	100.0	0.0	0.0	13.0	3.7	e
2 Architect	11	100.0	0.0	0.0	10.1	7.6	e*
3 VIDAS	7	85.7	0.0	14.3	11.6	5.6	e

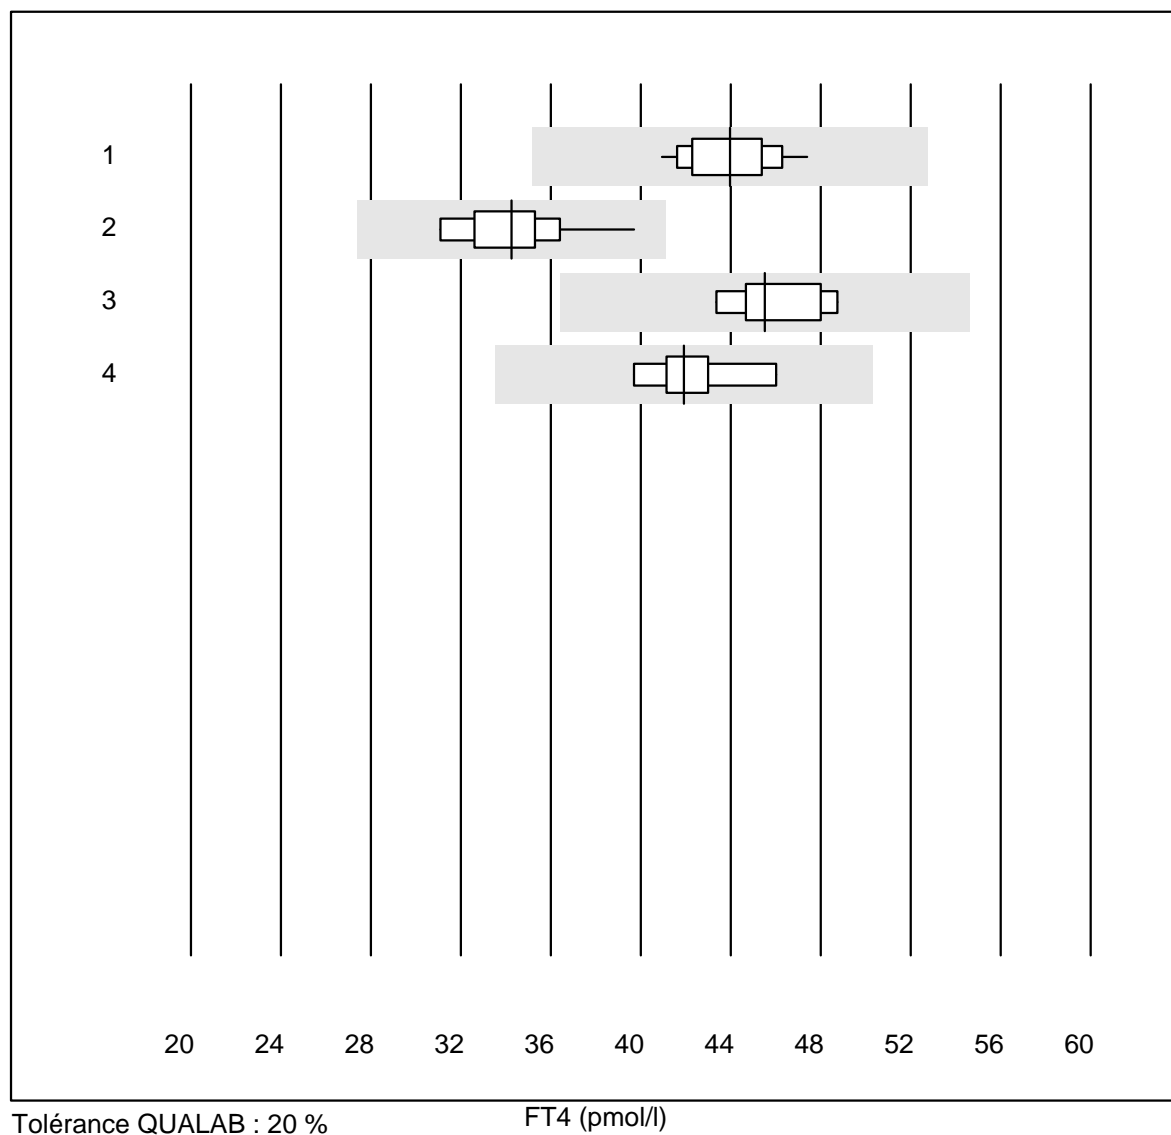FT4


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	12	100.0	0.0	0.0	44.0	4.6	e
2 Architect	12	100.0	0.0	0.0	34.2	7.0	e
3 VIDAS	7	100.0	0.0	0.0	45.5	4.2	e
4 Autres méthodes	5	100.0	0.0	0.0	41.9	5.6	e*

Testostérone

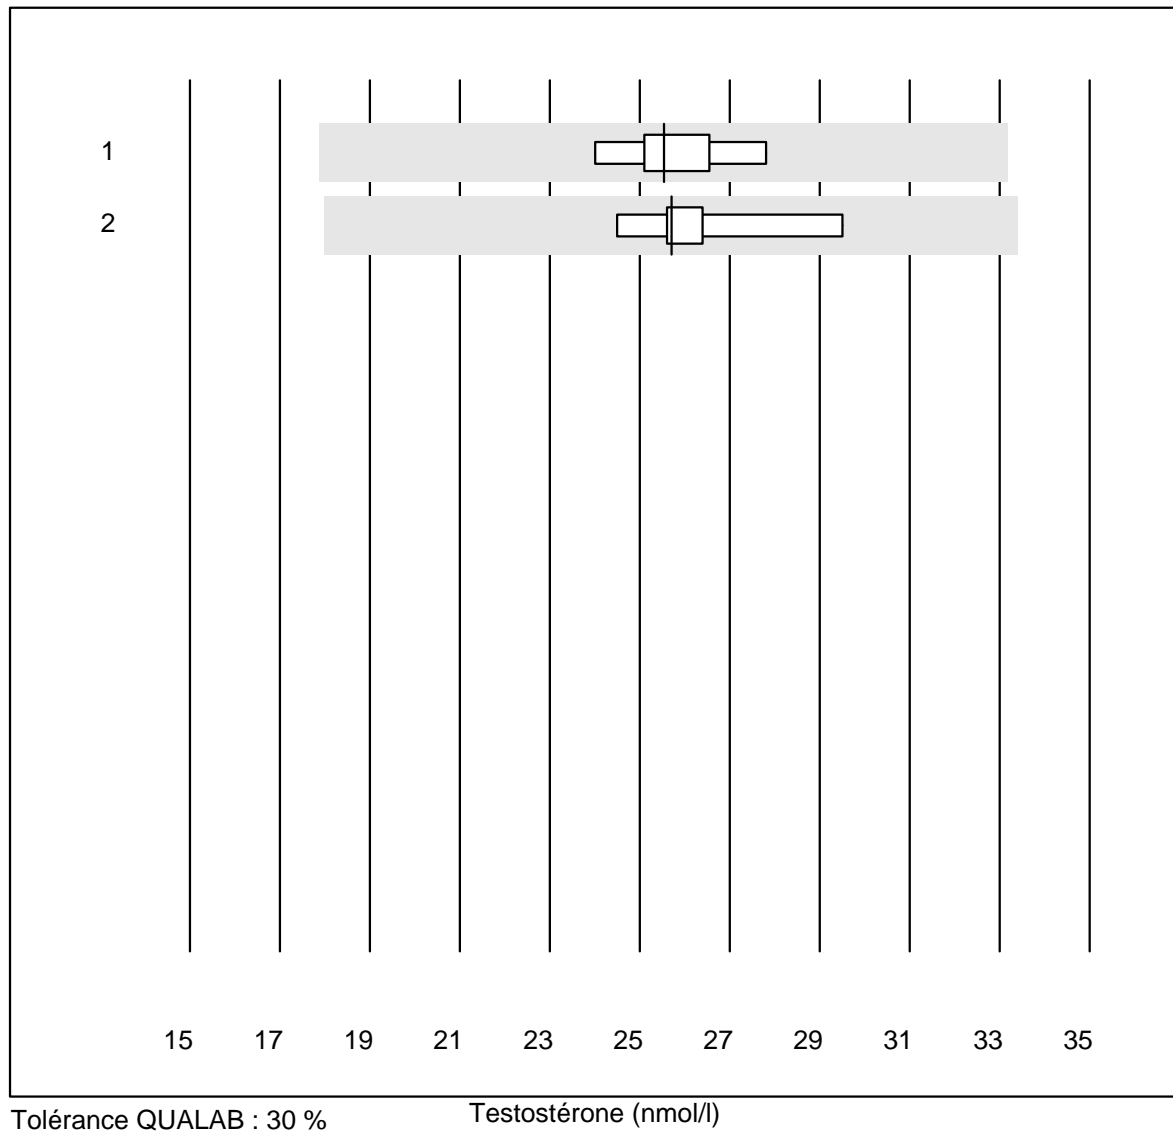

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	26	5.6	e
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	26	7.2	e

Estradiol

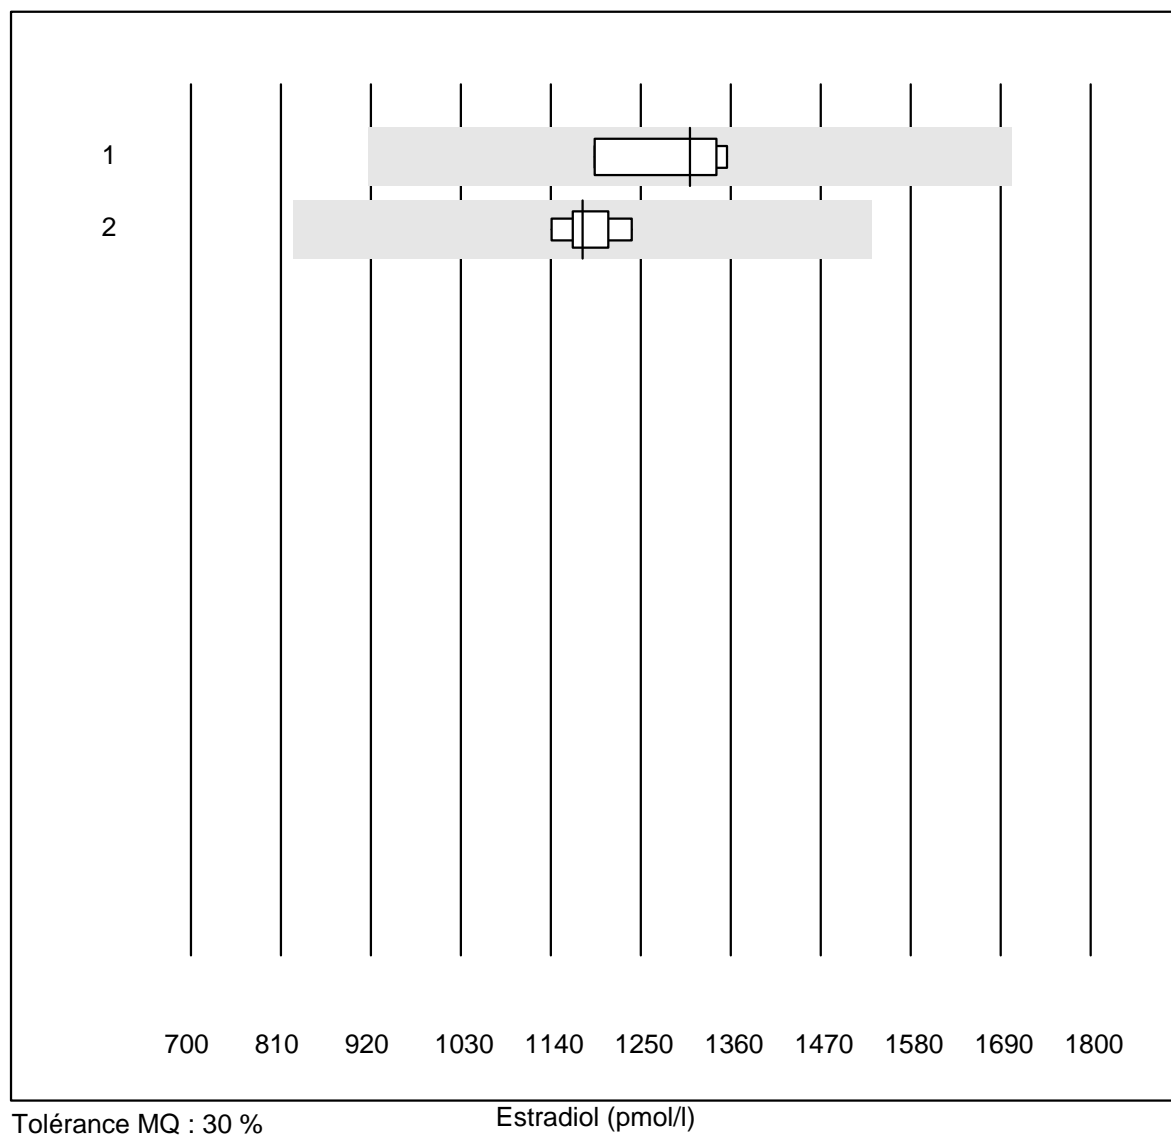


Tolérance MQ : 30 %

Estradiol (pmol/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	1311	5.7	e
2 Architect	6	100.0	0.0	0.0	1179	2.9	e

SHBG

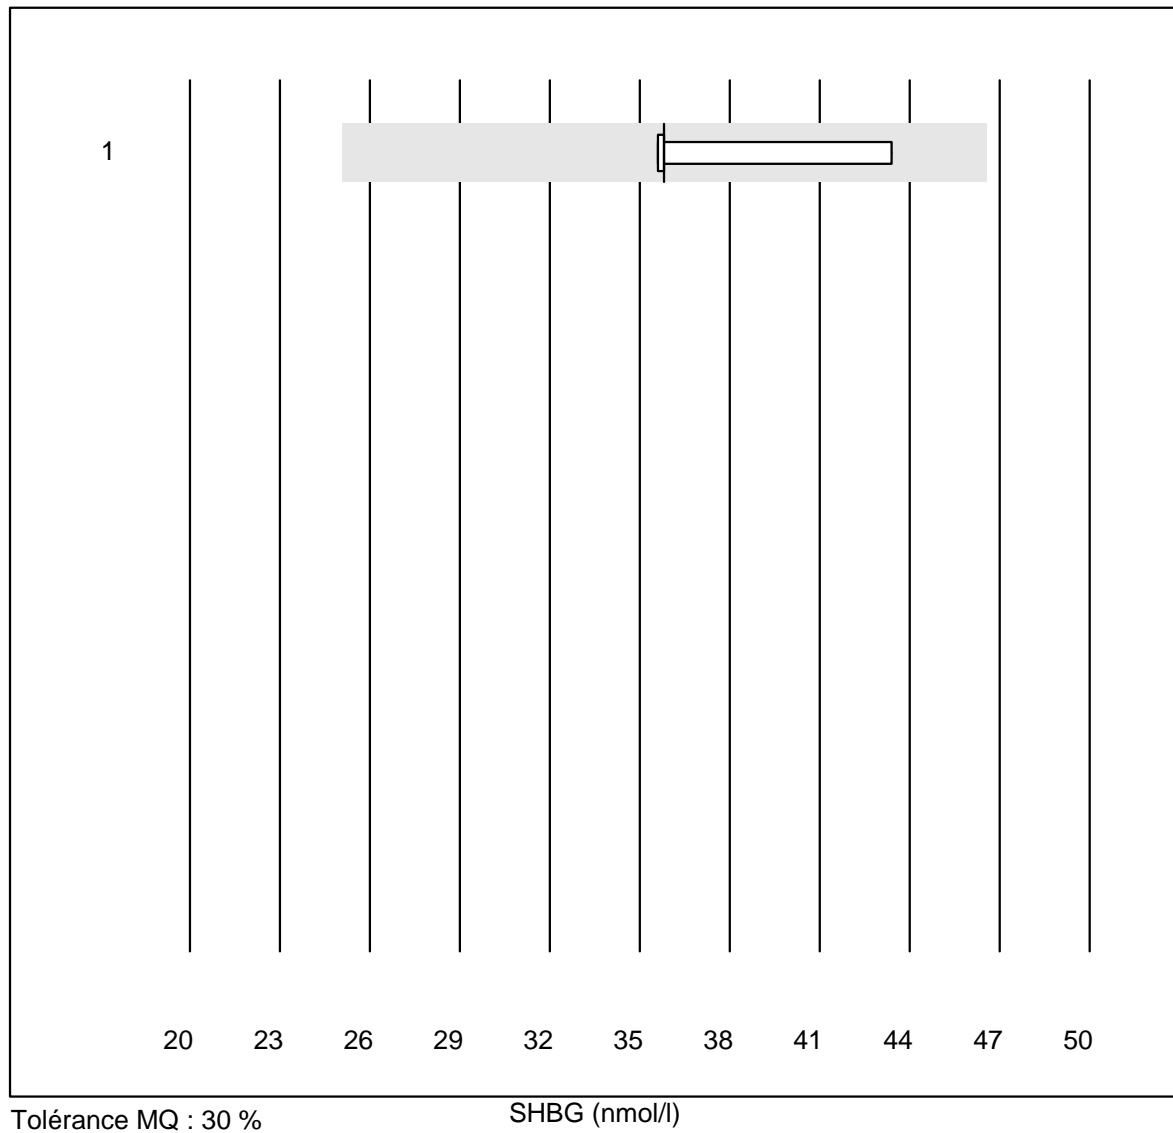

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Architect	4	100.0	0.0	0.0	35.8	10.2	e*

Cortisol

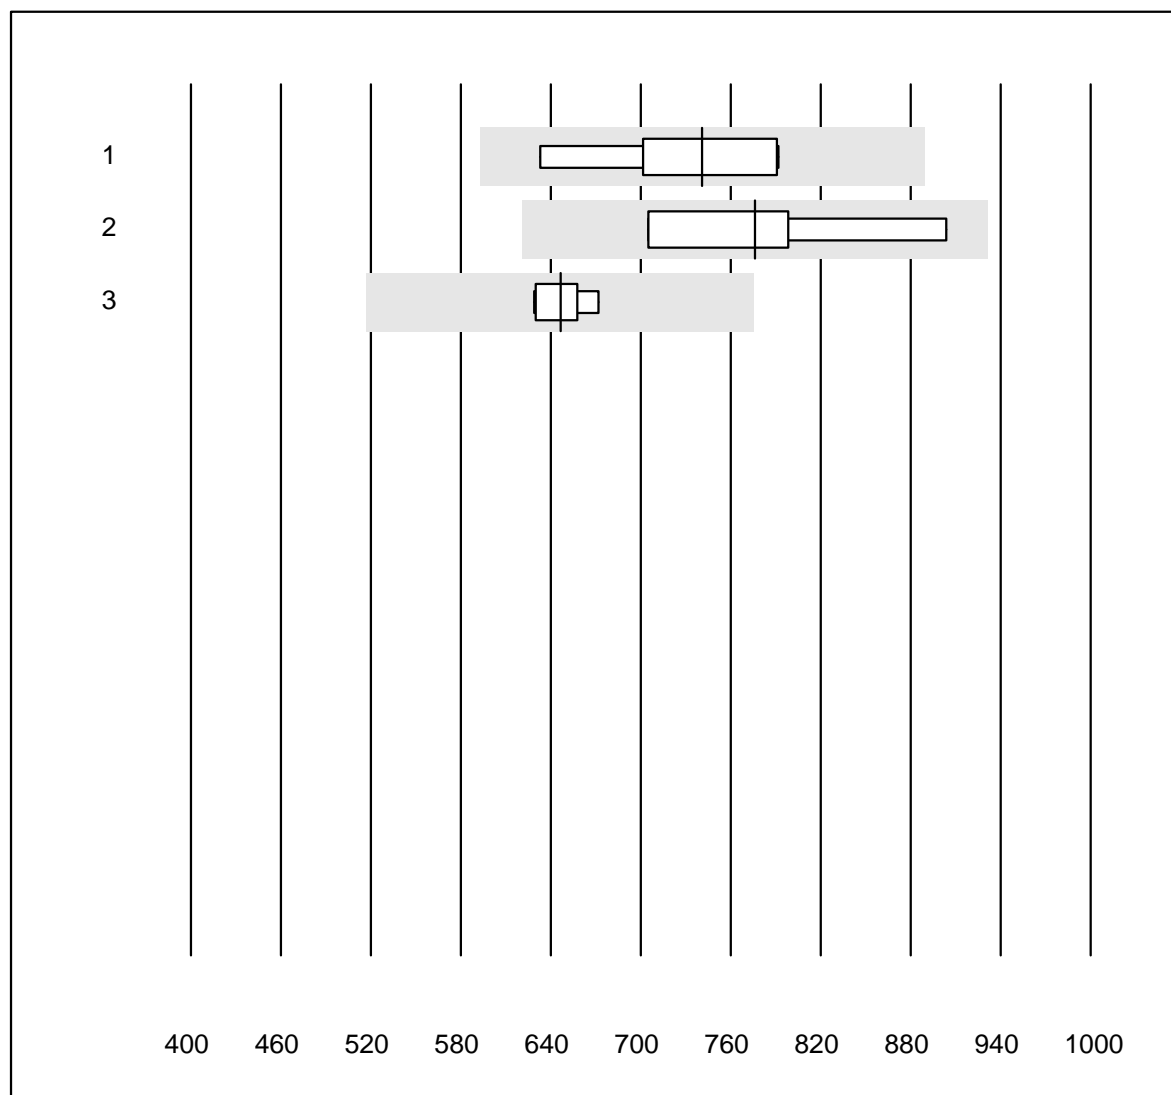


Tolérance QUALAB : 20 %


Cortisol (nmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	6	100.0	0.0	0.0	741	8.5	e*
2	ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	776	10.7	e*
3	Architect	6	100.0	0.0	0.0	647	2.7	e

Progesteron

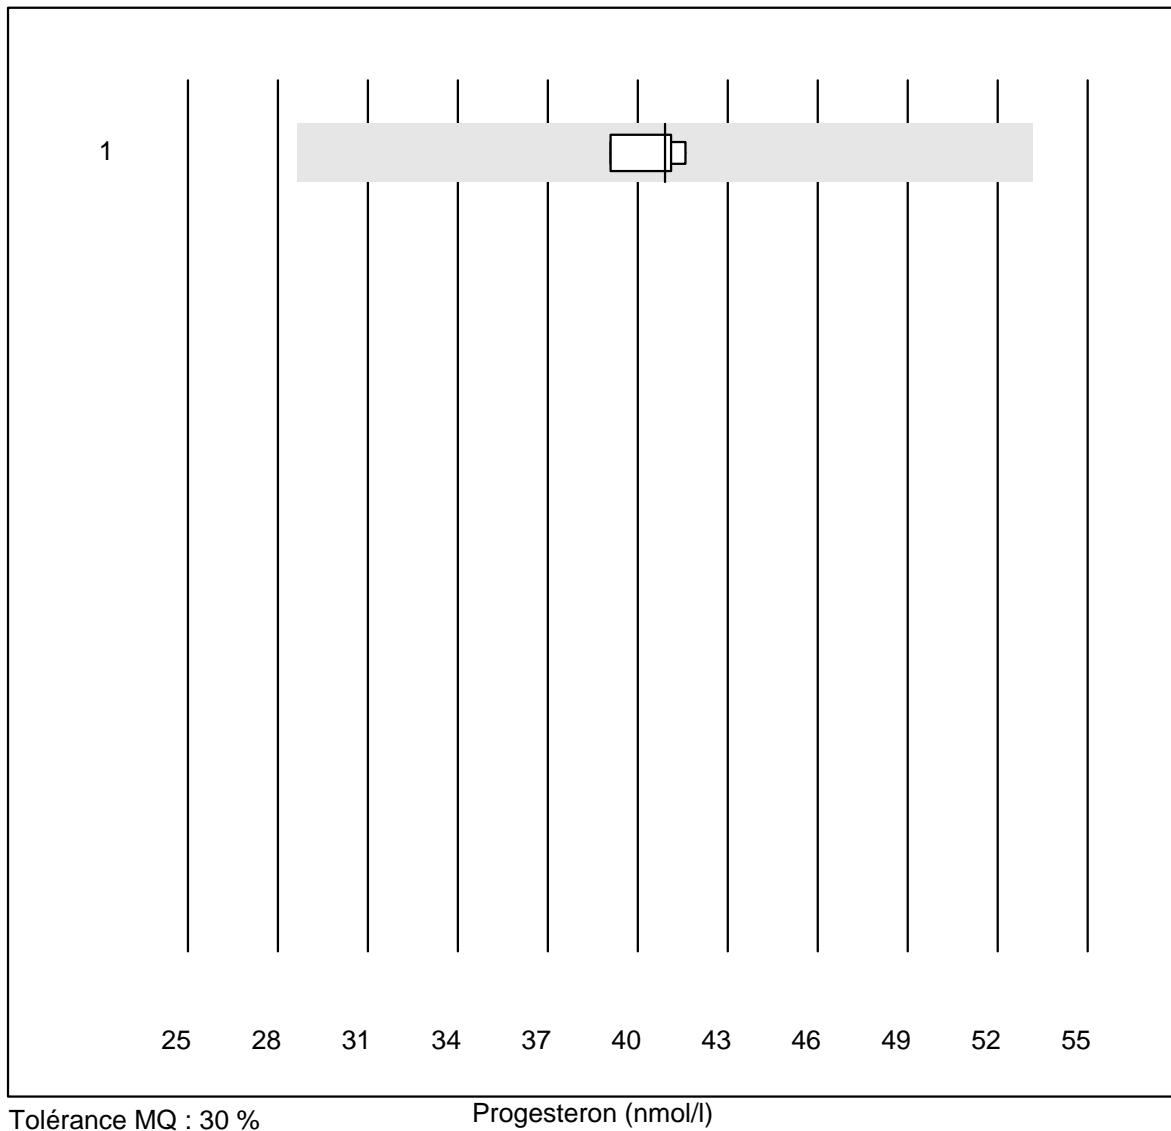


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Architect	4	100.0	0.0	0.0	40.9	2.7	e

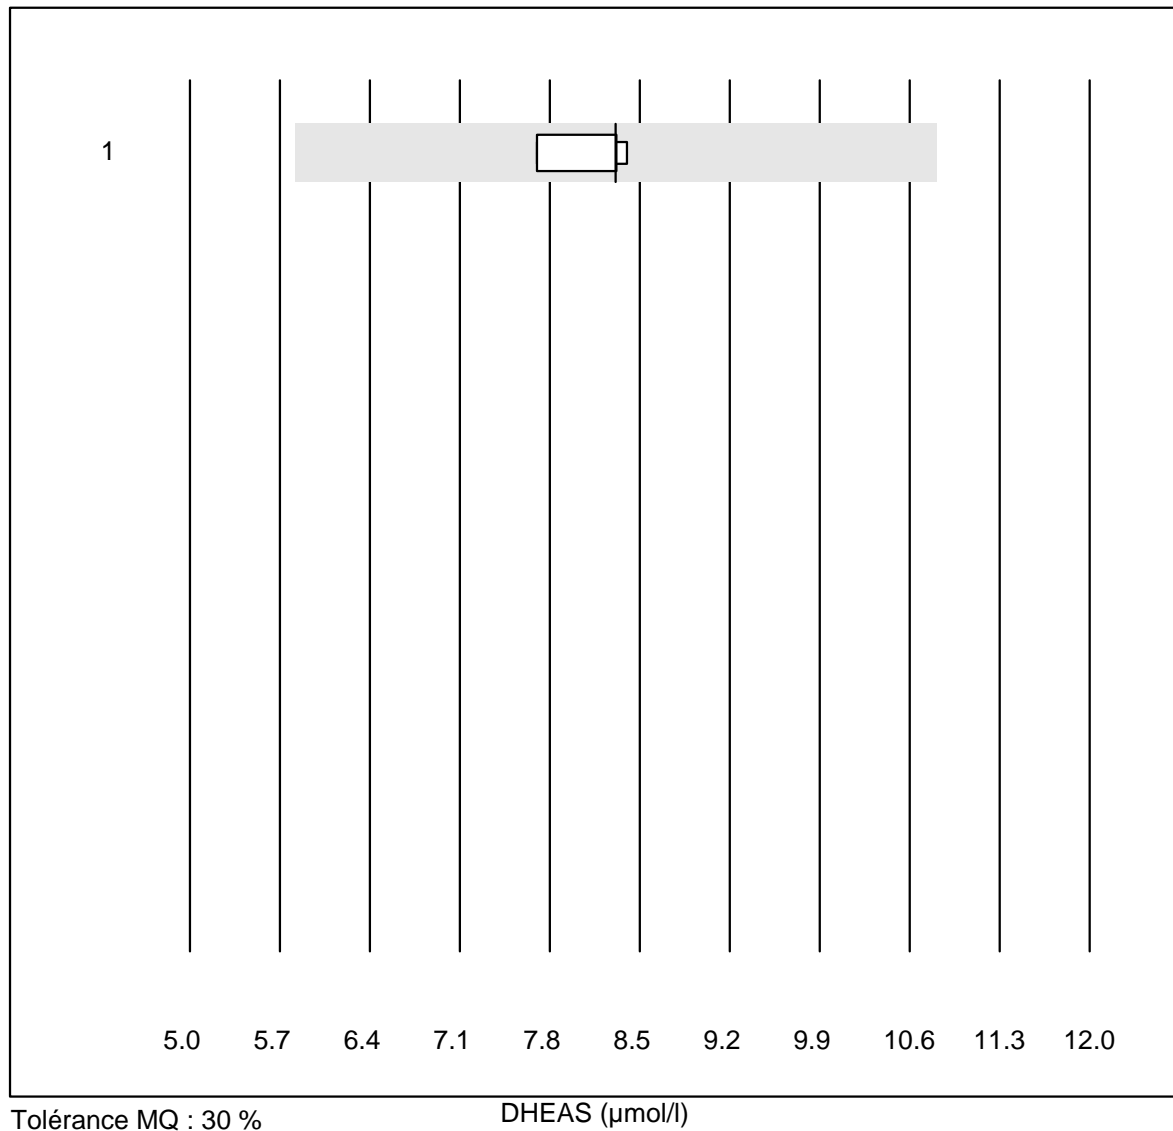DHEAS

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Architect	4	100.0	0.0	0.0	8.31	3.9	e

Luteinisierendes Hormon

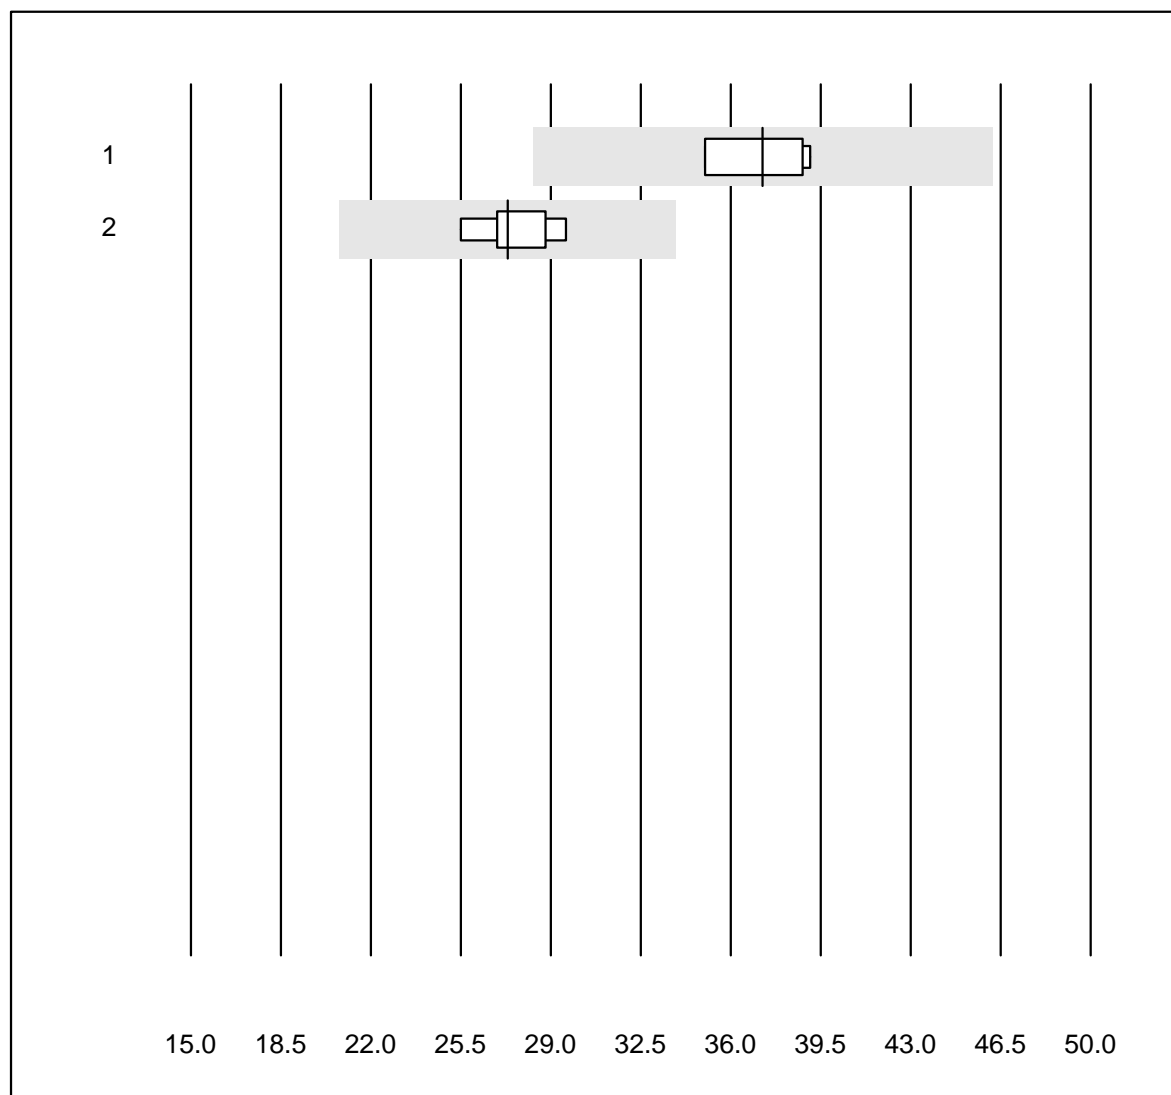


Tolérance QUALAB : 24 %

Luteinisierendes Hormon (U/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Roche, Cobas	4	100.0	0.0	0.0	37.2	5.7	e
2	Architect	7	100.0	0.0	0.0	27.3	4.9	e


Follikelstimulierendes Hormon

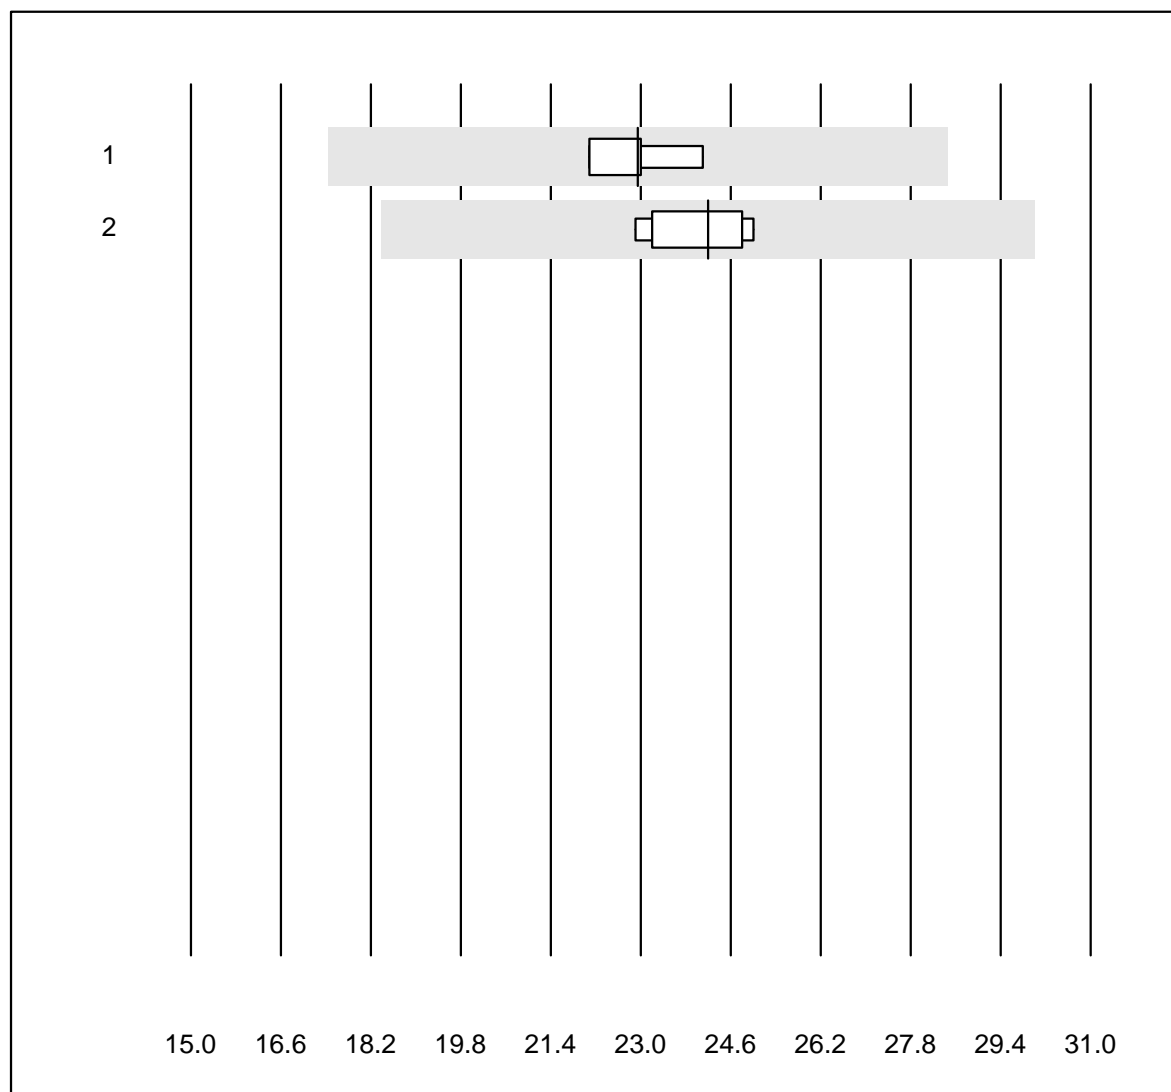

Tolérance QUALAB : 24 % Follikelstimulierendes Hormon (U/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Roche, Cobas	4	100.0	0.0	0.0	23.0	3.6	e
2	Architect	7	100.0	0.0	0.0	24.2	3.3	e


Prolaktin (PRL)

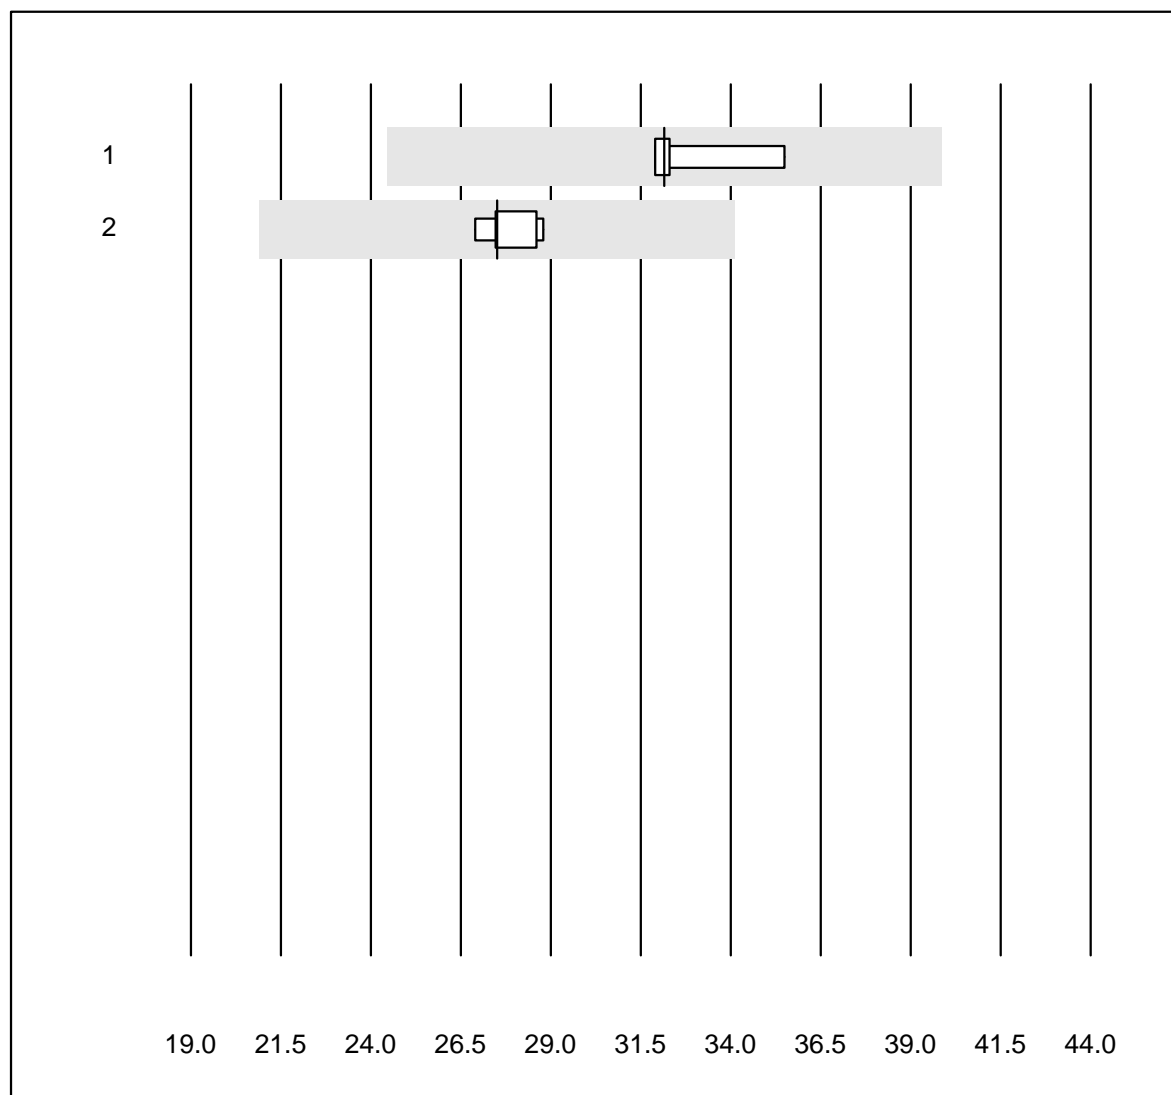

Tolérance QUALAB : 24 %


Prolaktin (PRL) (µg/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas/Roche	4	100.0	0.0	0.0	32.2	5.2	e
2 Architect	6	100.0	0.0	0.0	27.5	2.7	e

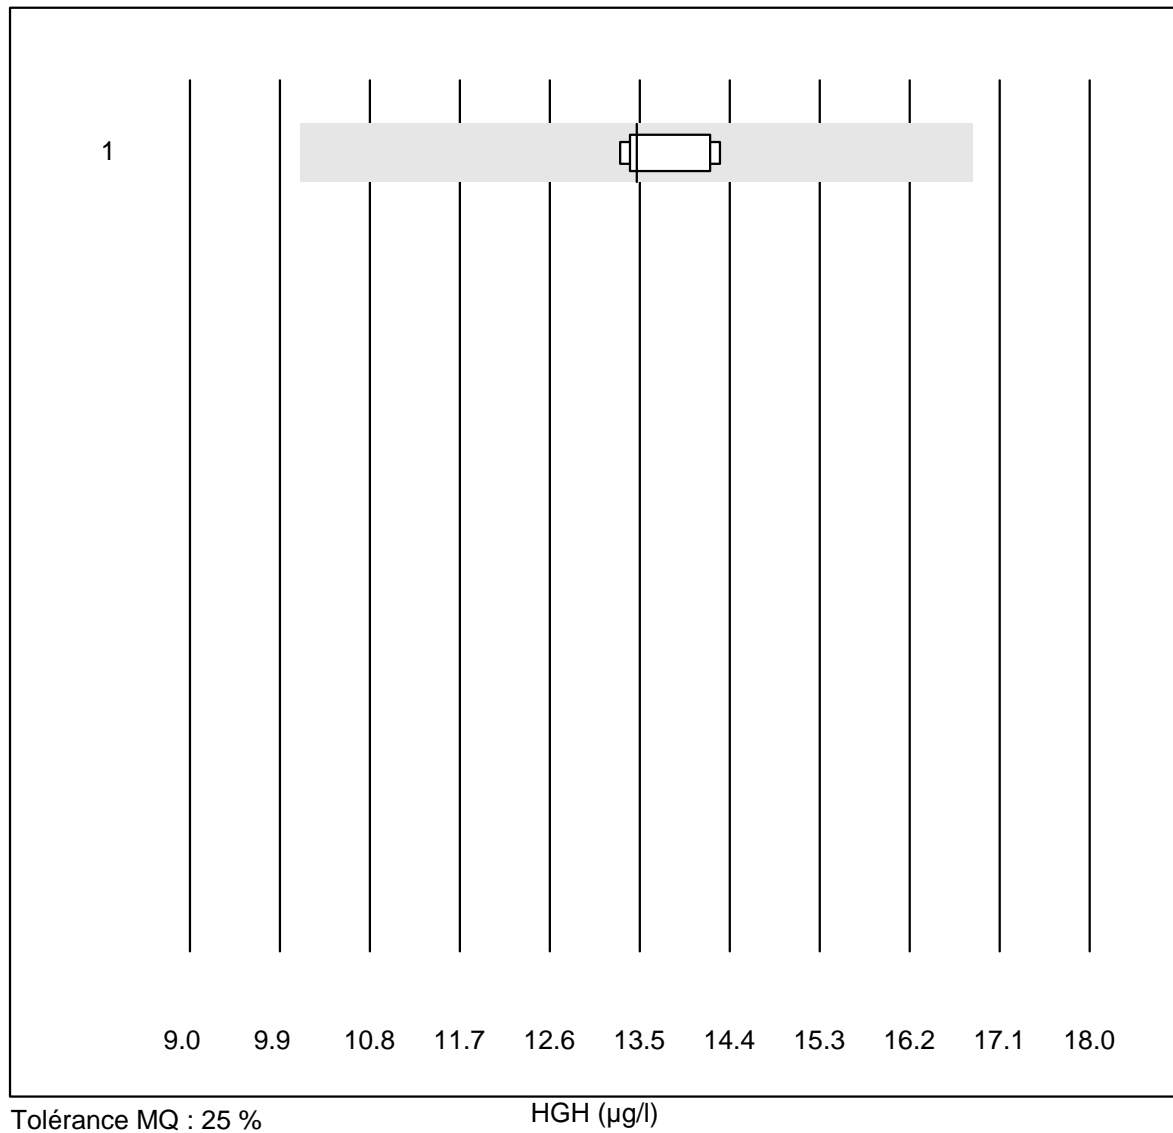HGH

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	13.47	3.2	e


Freies Testostéron

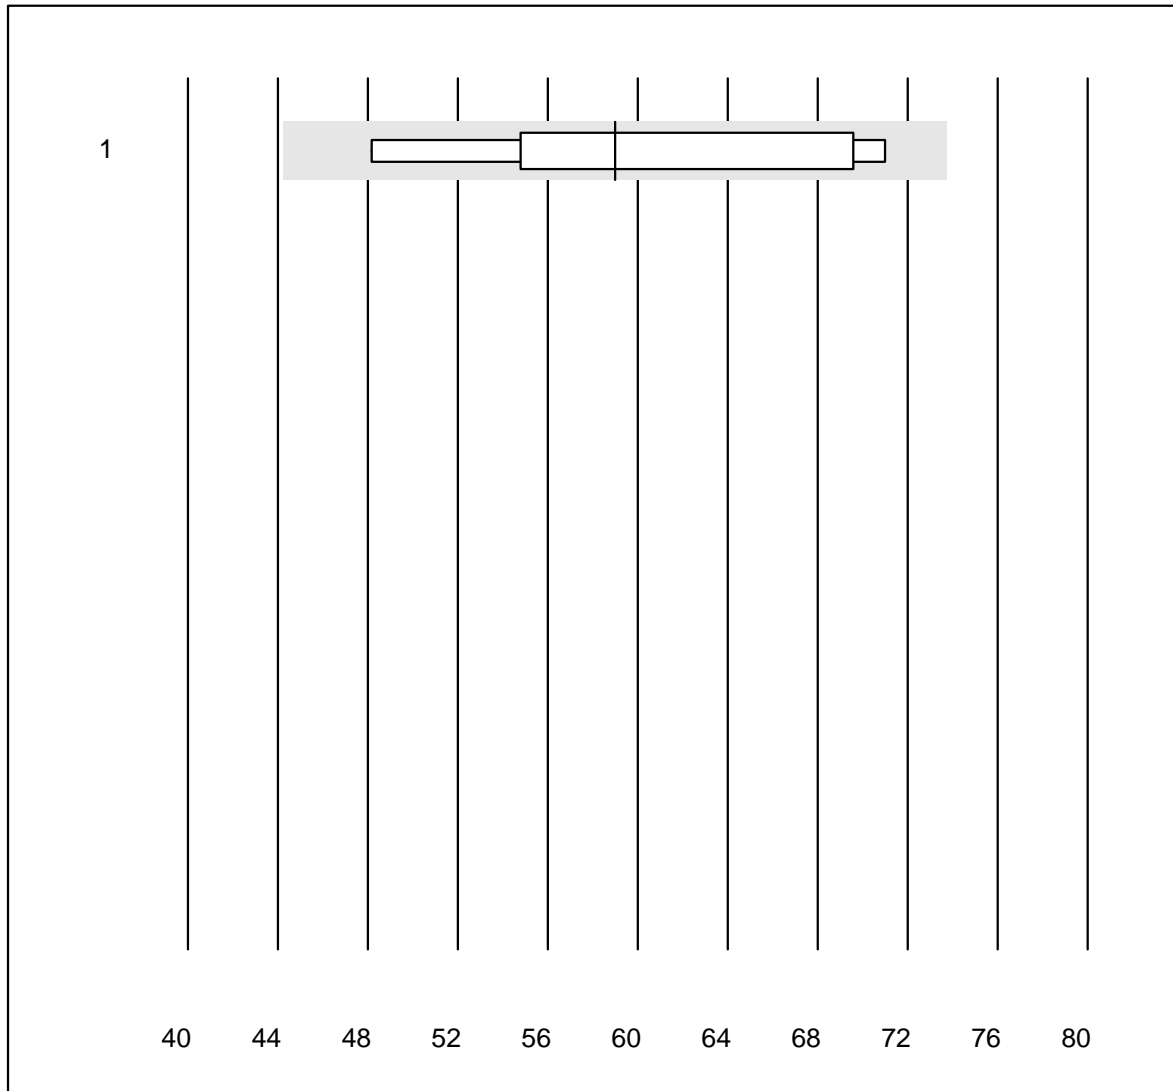

Tolérance MQ : 25 %


Freies Testostéron (pmol/l)

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	59.0	16.8 a

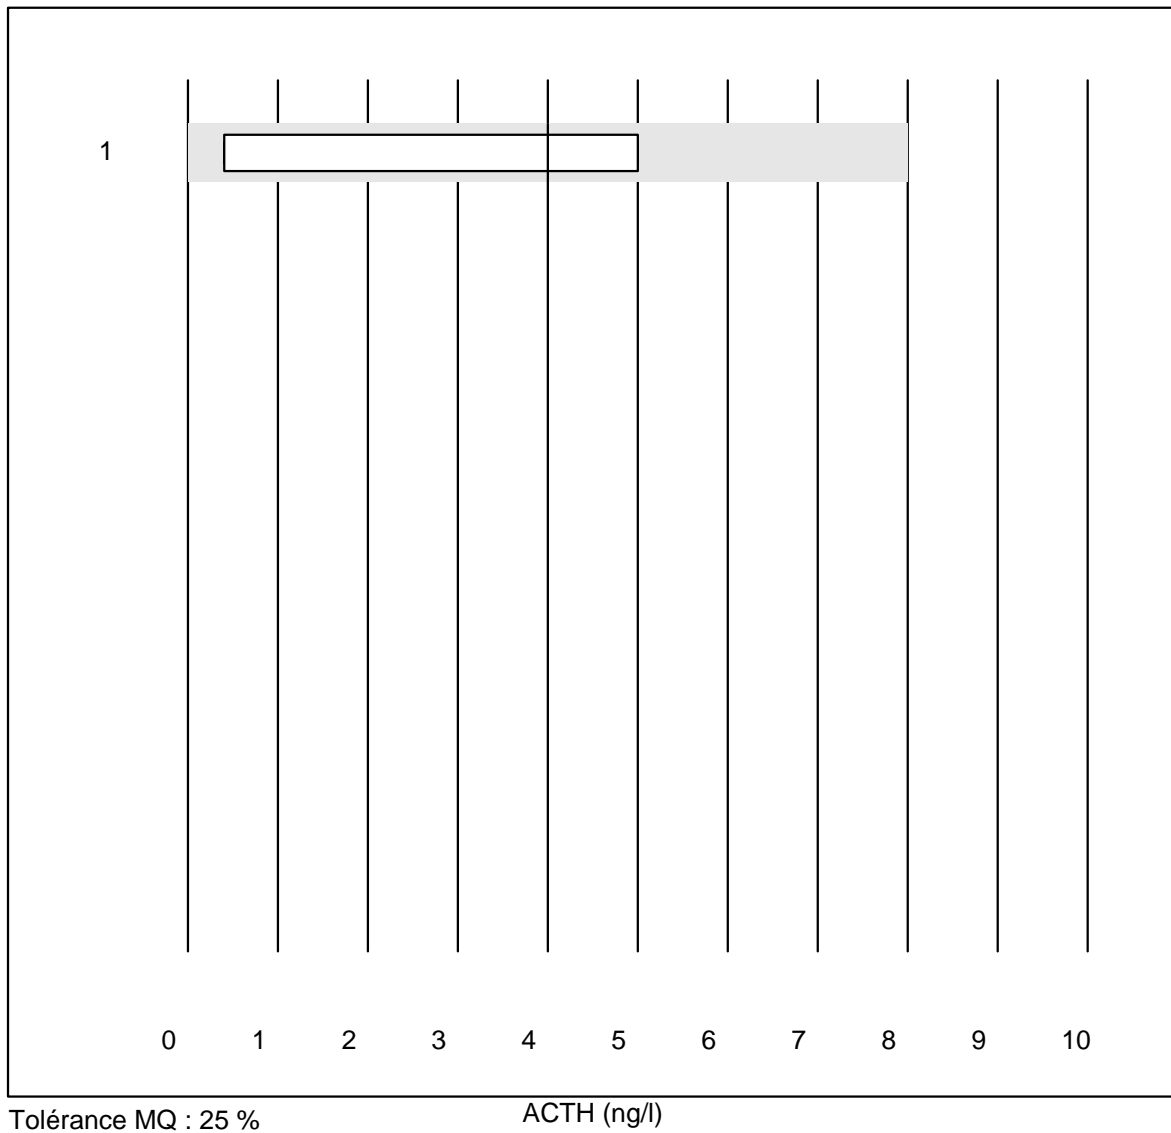ACTH


No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	4	86.4	a

IGF-1

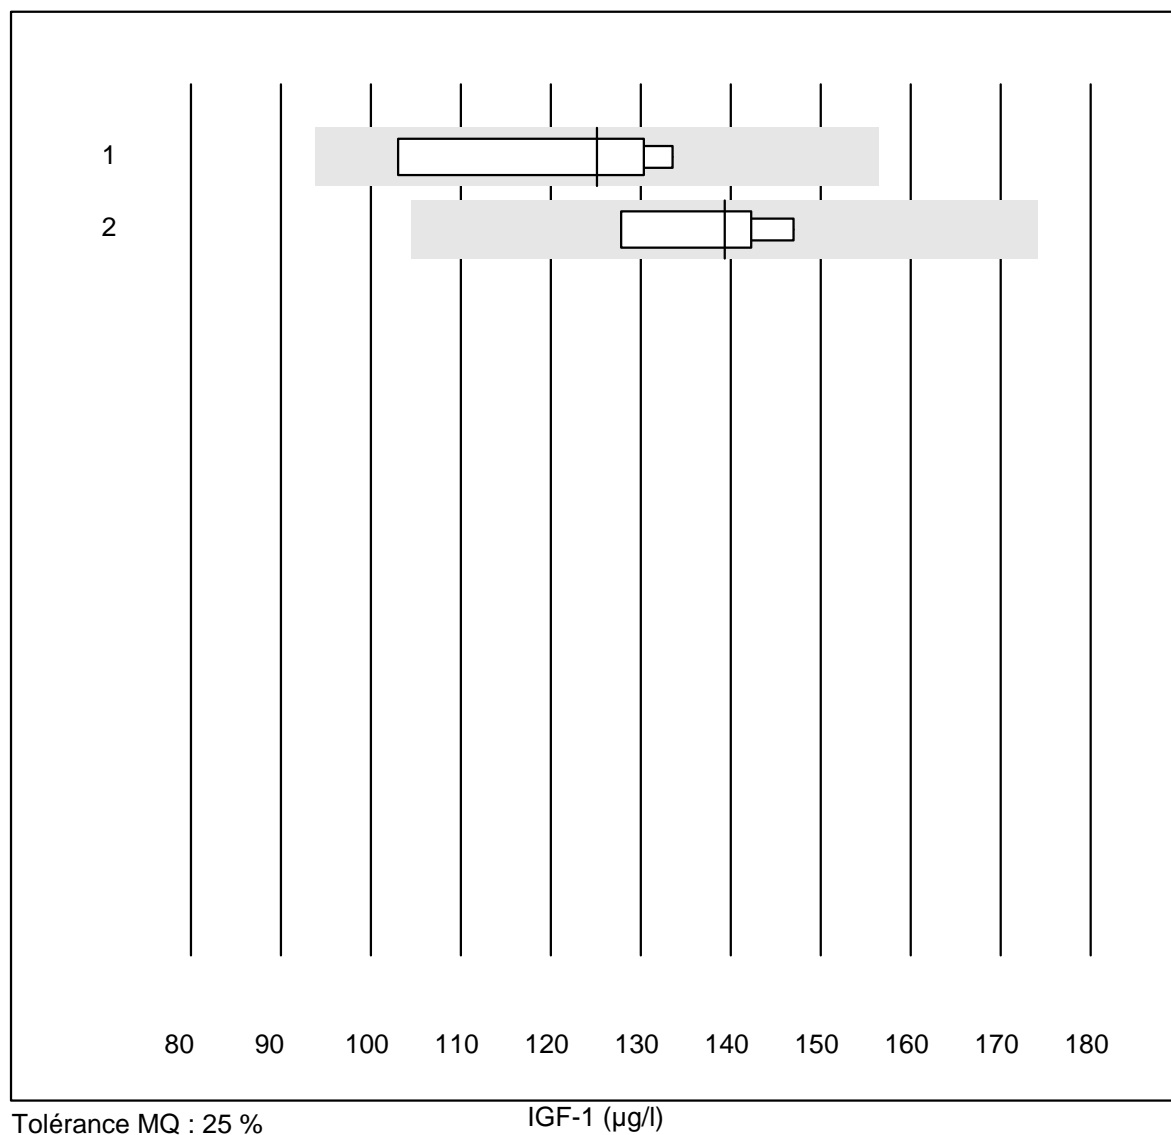

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	125	11.3	e*
2	Liaison	4	100.0	0.0	0.0	139	6.0	e

Troponine T CR

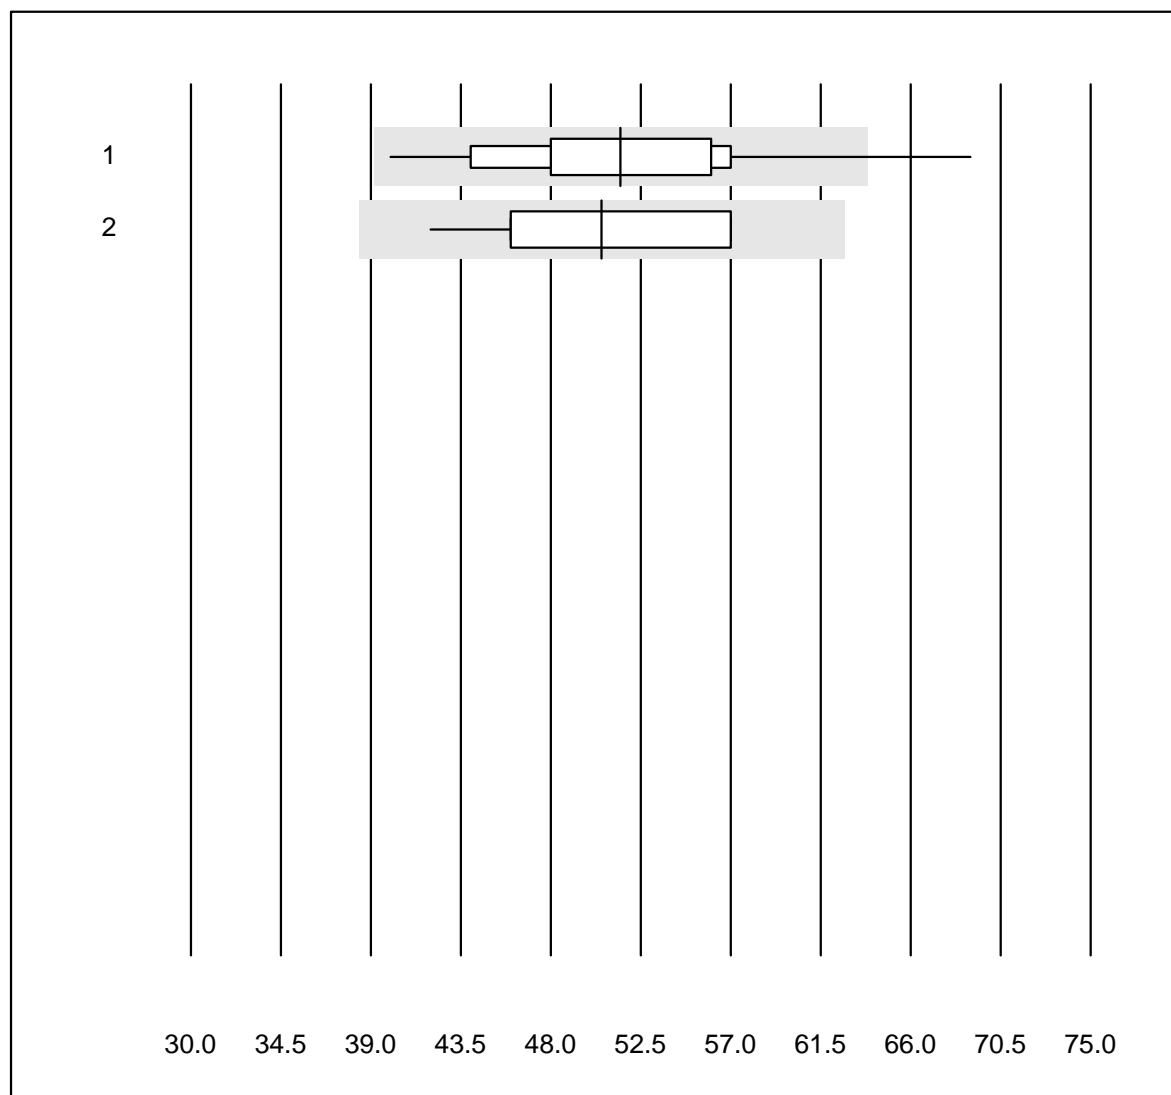


Tolérance QUALAB : 24 %

Troponine T CR (ng/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas h 232	1050	97.6	2.2	0.2	51.49	10.8	e
2	Cardiac Reader	13	100.0	0.0	0.0	50.54	10.0	e

D-Dimères CR

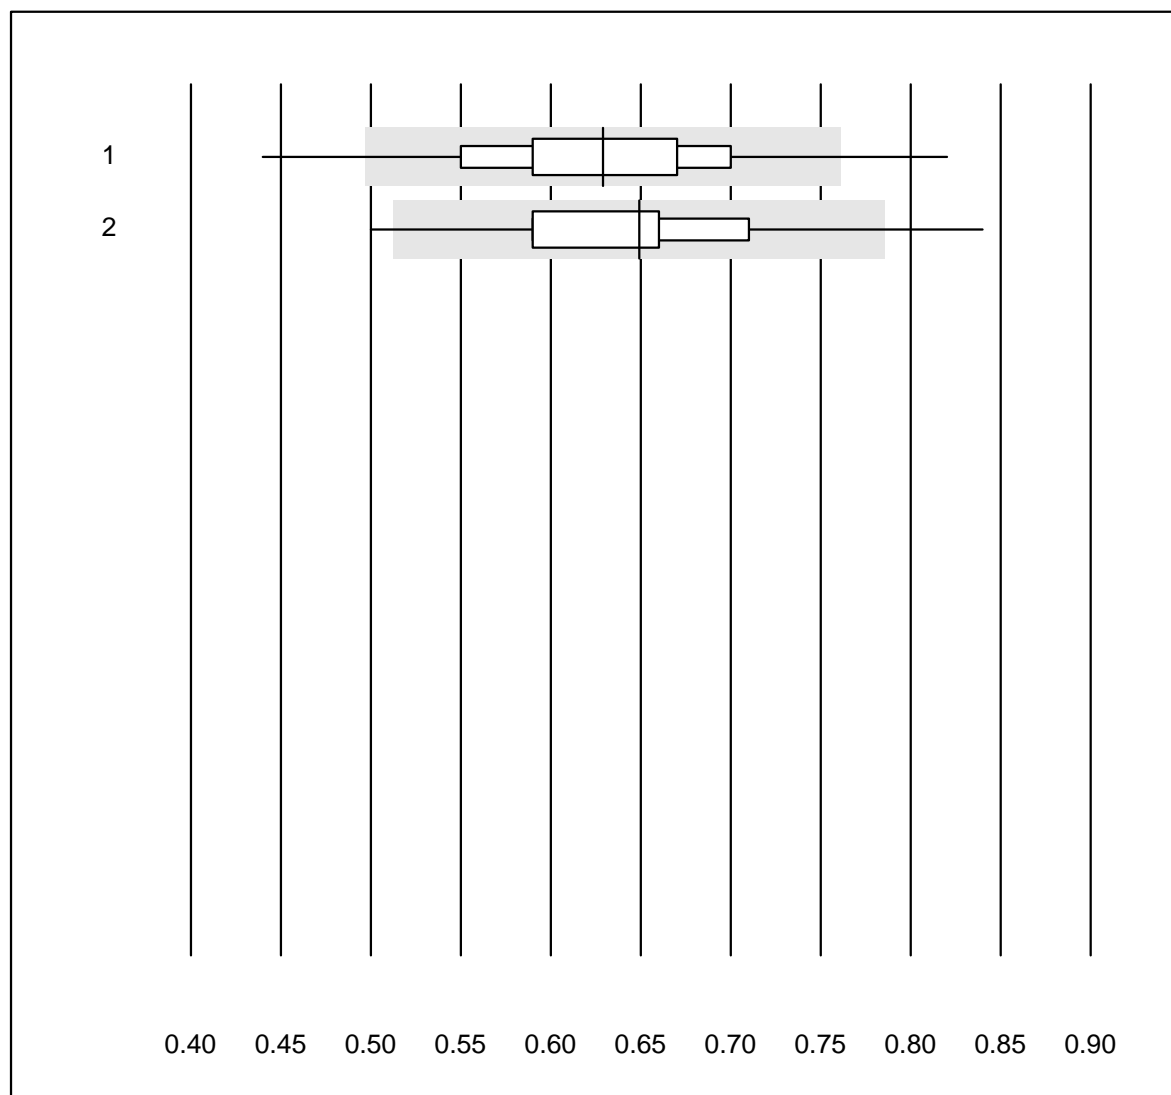


Tolérance QUALAB : 21 %

D-Dimères CR (mg/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas h 232	1067	91.9	4.5	3.6	0.63	10.0	e
2	Cardiac Reader	12	83.3	16.7	0.0	0.65	12.4	e*

CKMB- K8

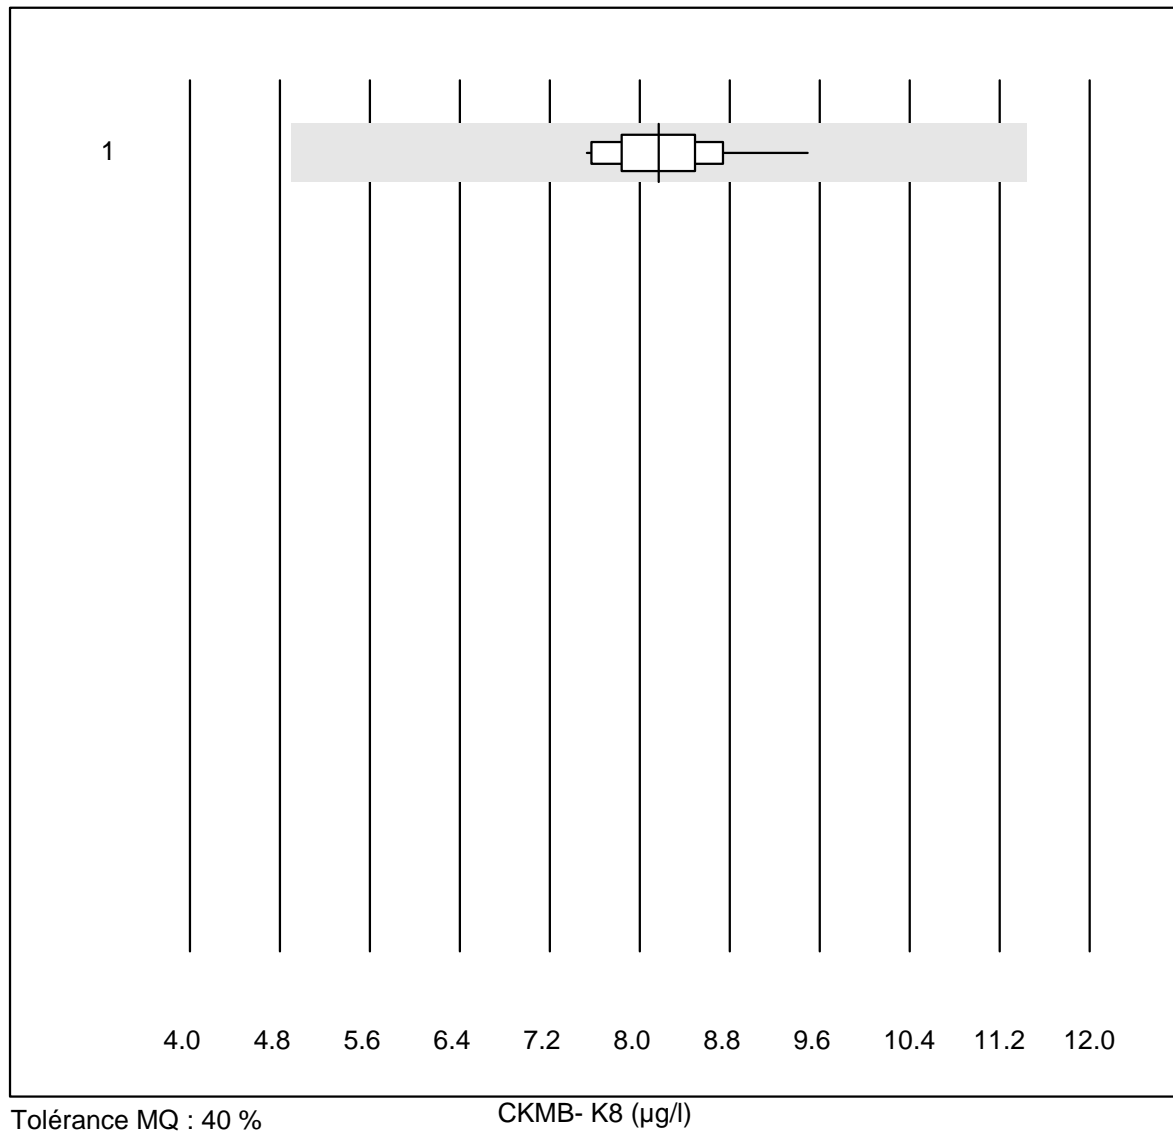


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas h 232	13	100.0	0.0	0.0	8.2	6.6	e

NT-proBNP CR

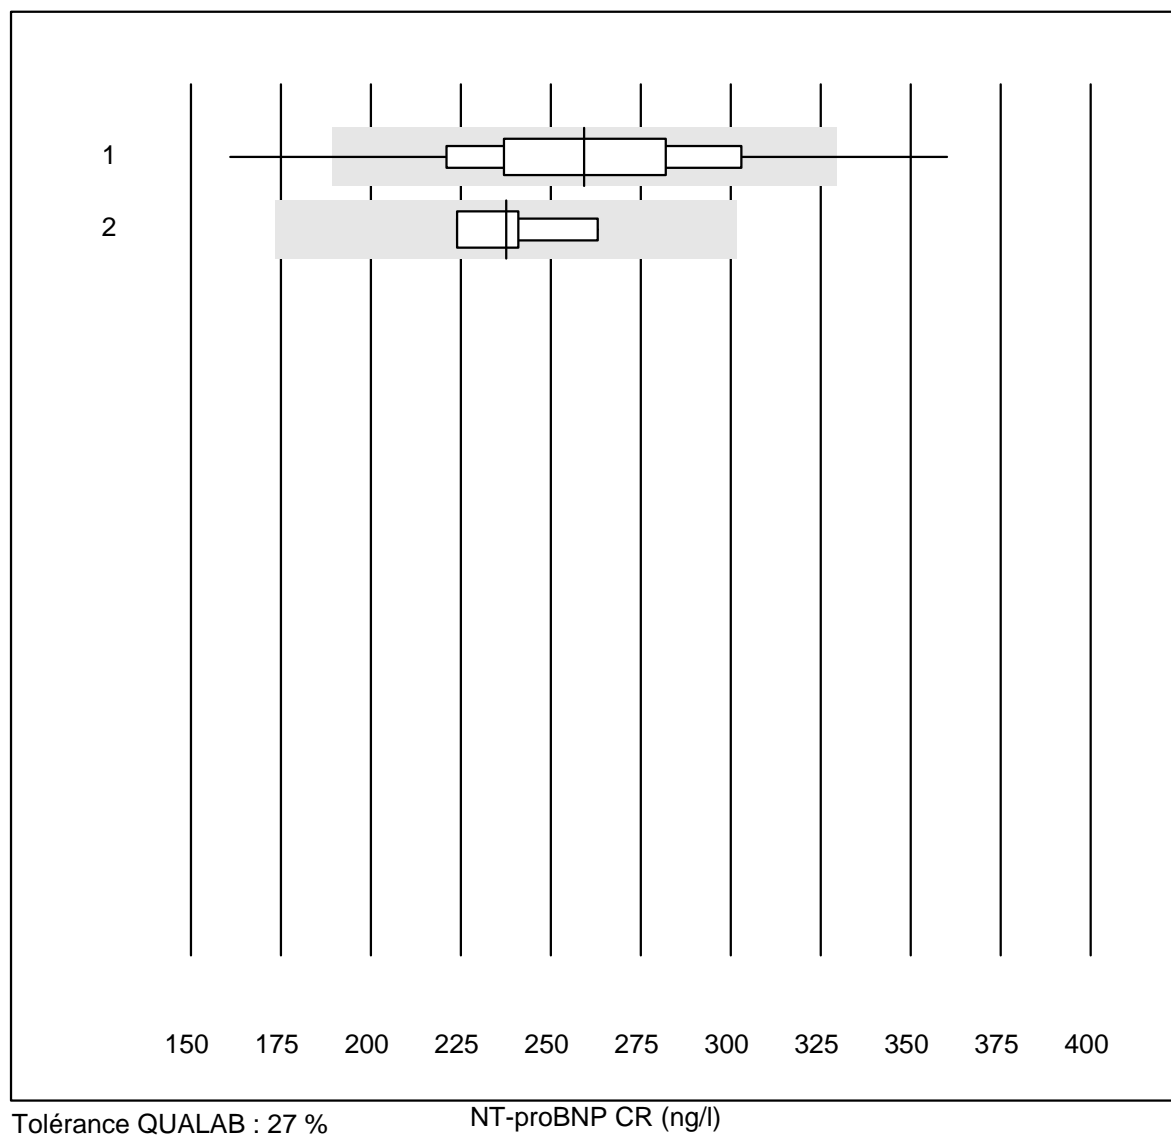

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas h 232	653	96.5	3.2	0.3	259	12.5	e
2	Cardiac Reader	4	100.0	0.0	0.0	238	6.9	e*

PCO2 CCA

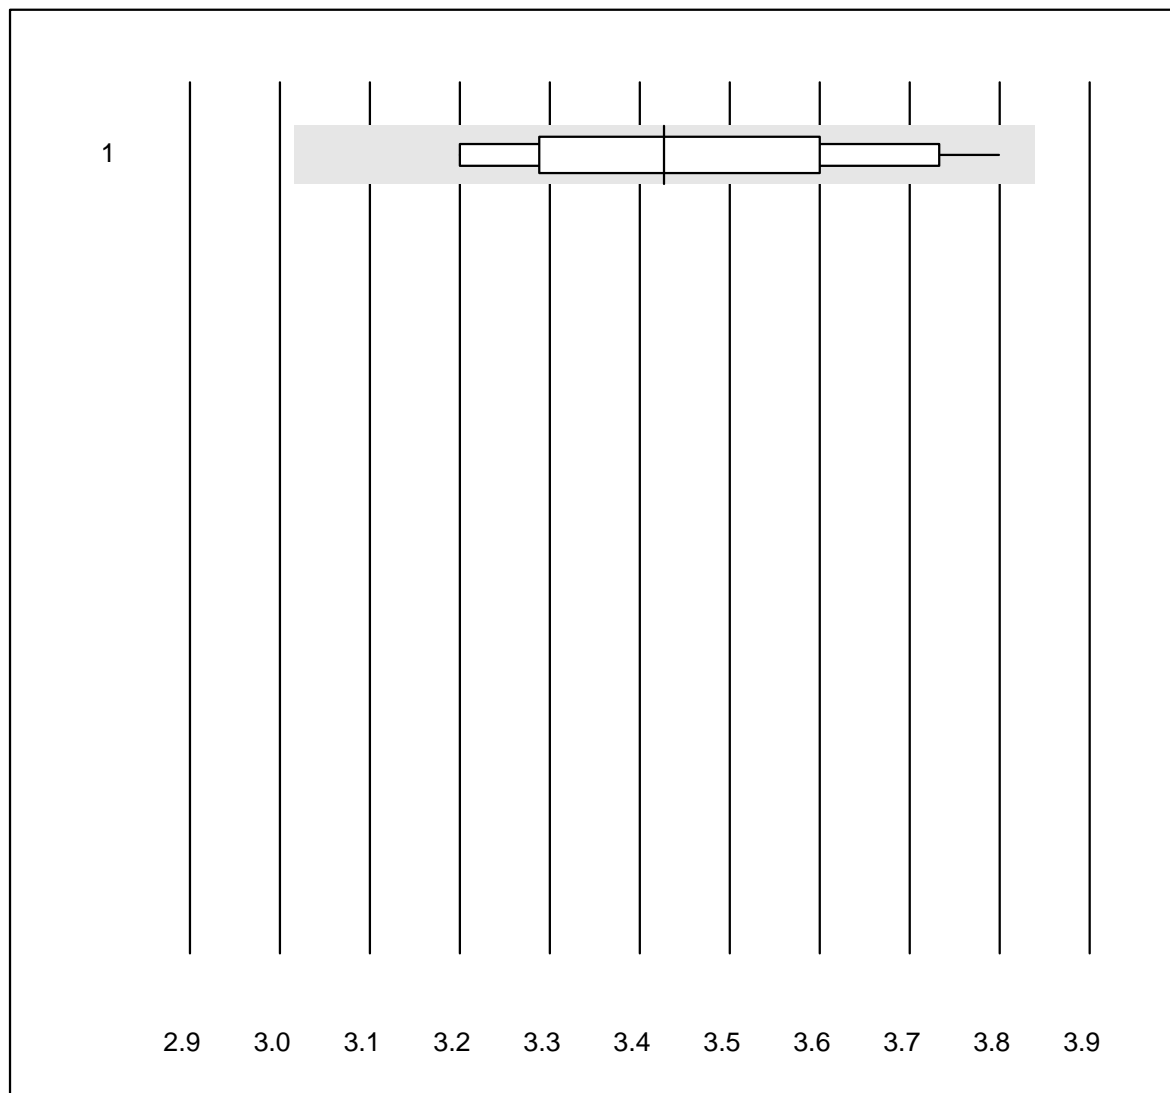


Tolérance QUALAB : 12 %

PCO2 CCA (kPa)

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 OPTI CCA	14	92.9	0.0	7.1	3.43	5.8	e*

PO2 CCA

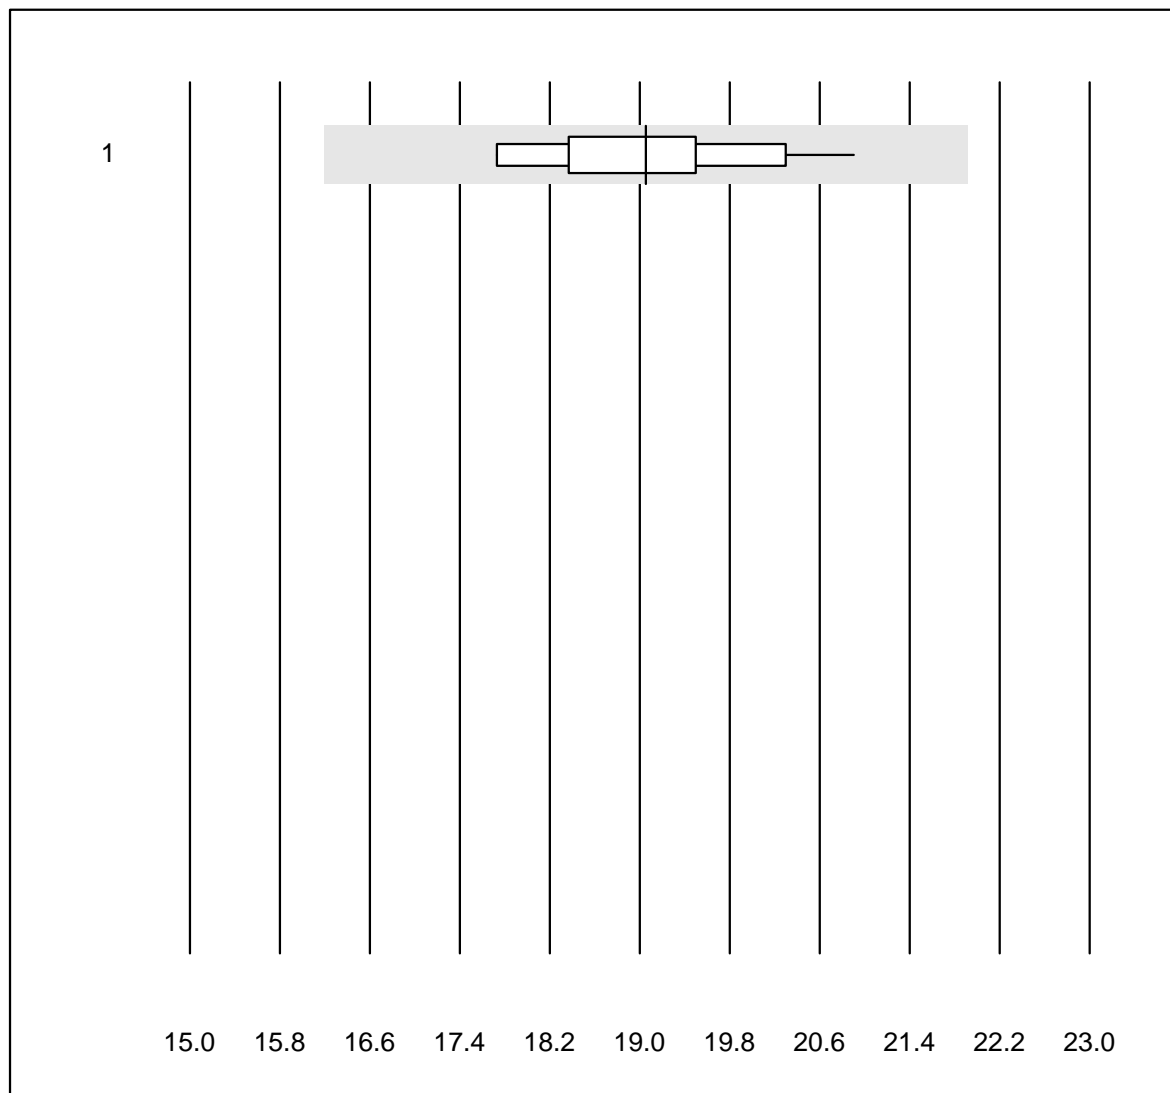


Tolérance QUALAB : 15 %

PO2 CCA (kPa)


No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 OPTI CCA	14	71.4	0.0	28.6	19.06	5.1	e

pH CCA

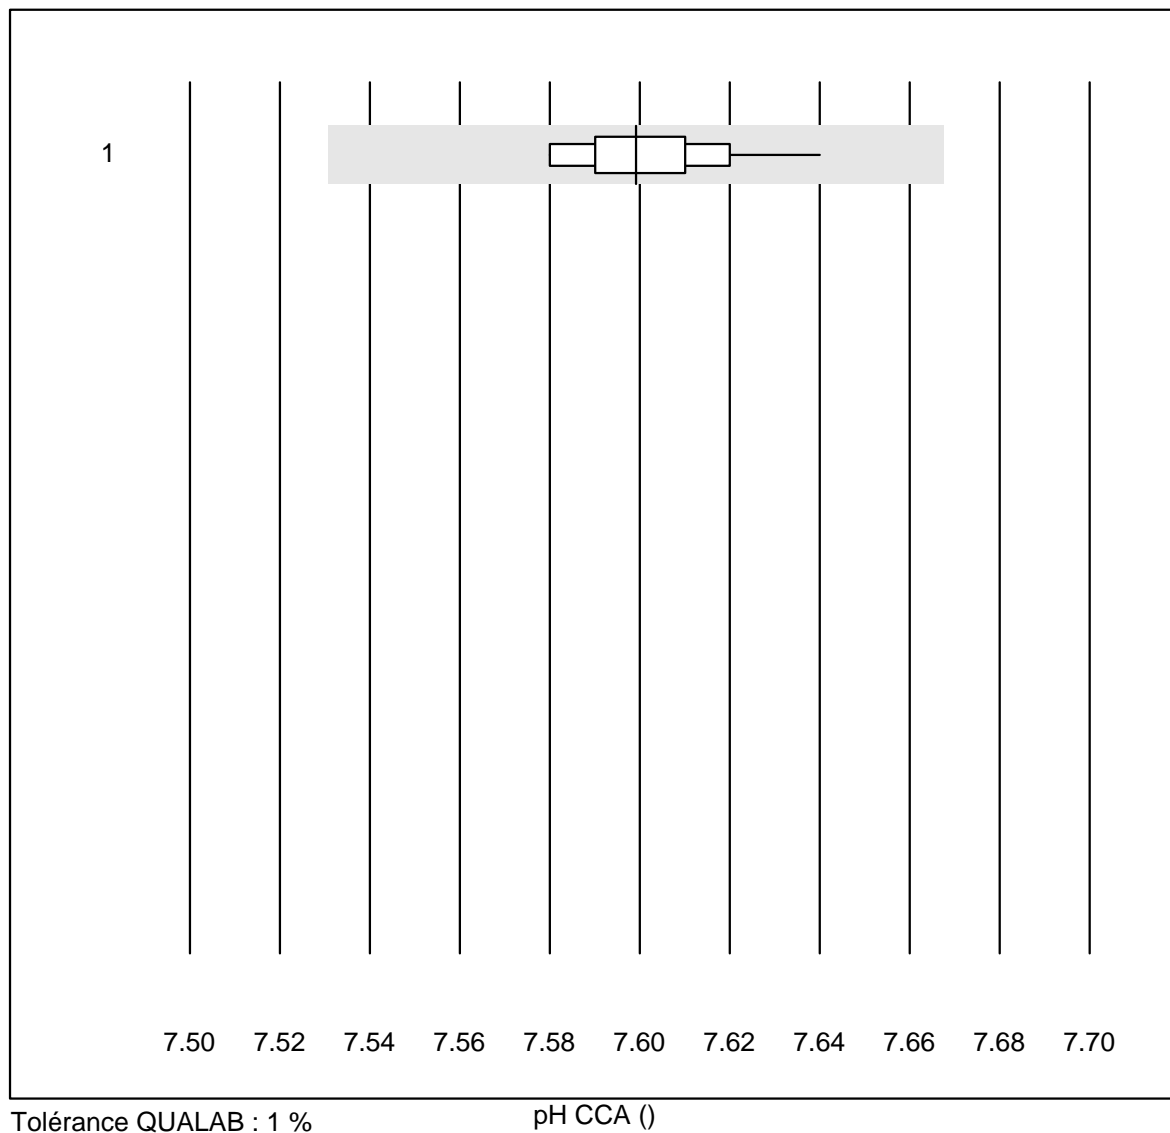

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 OPTI CCA	14	100.0	0.0	0.0	7.60	0.2	e

Potassium CCA

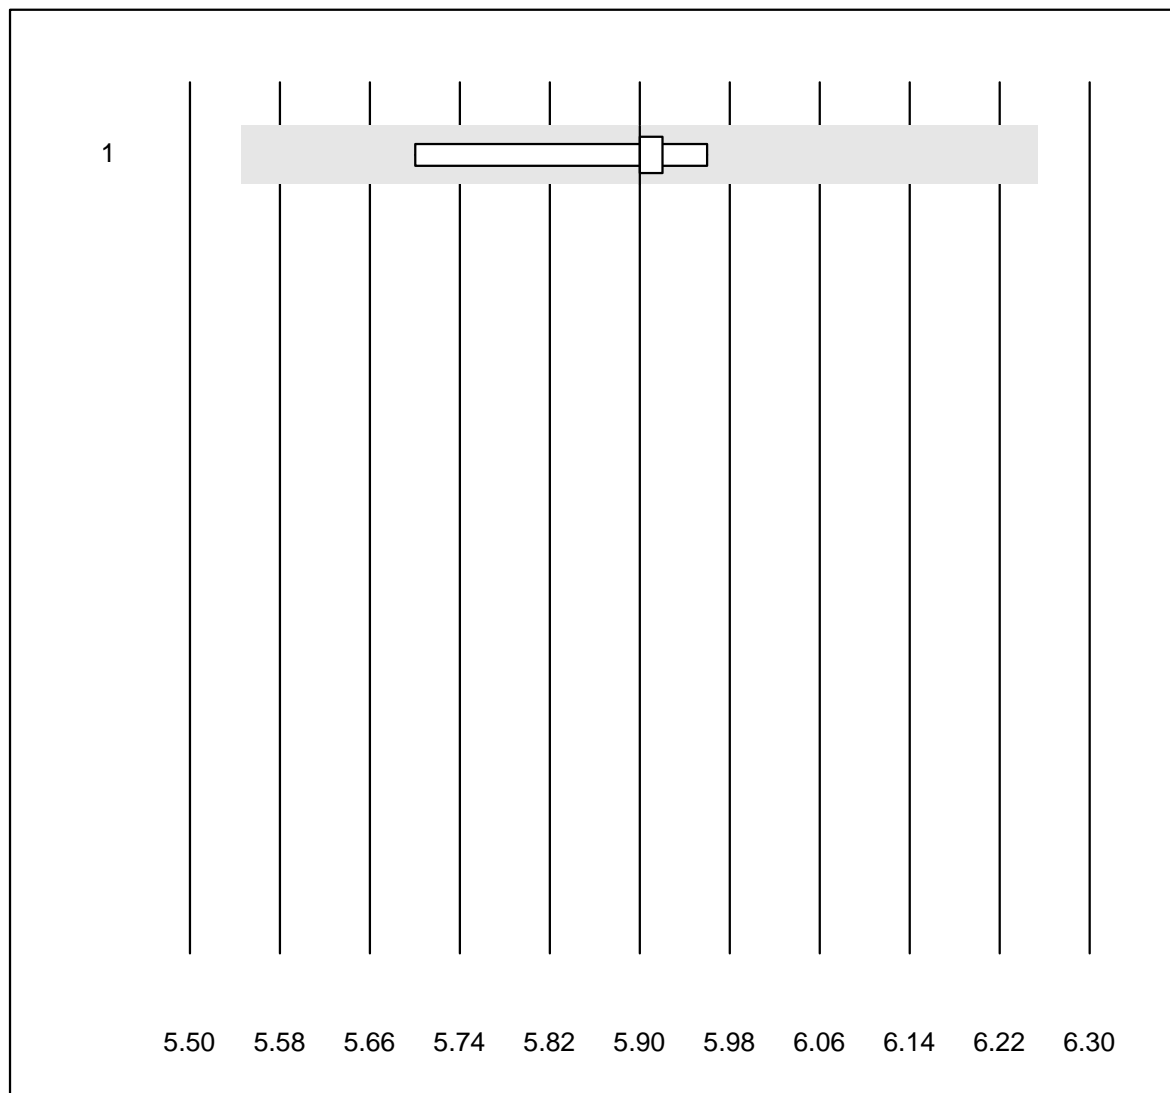


Tolérance QUALAB : 6 %

Potassium CCA (mmol/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 OPTI CCA	5	100.0	0.0	0.0	5.9	1.7	e*

Sodium CCA

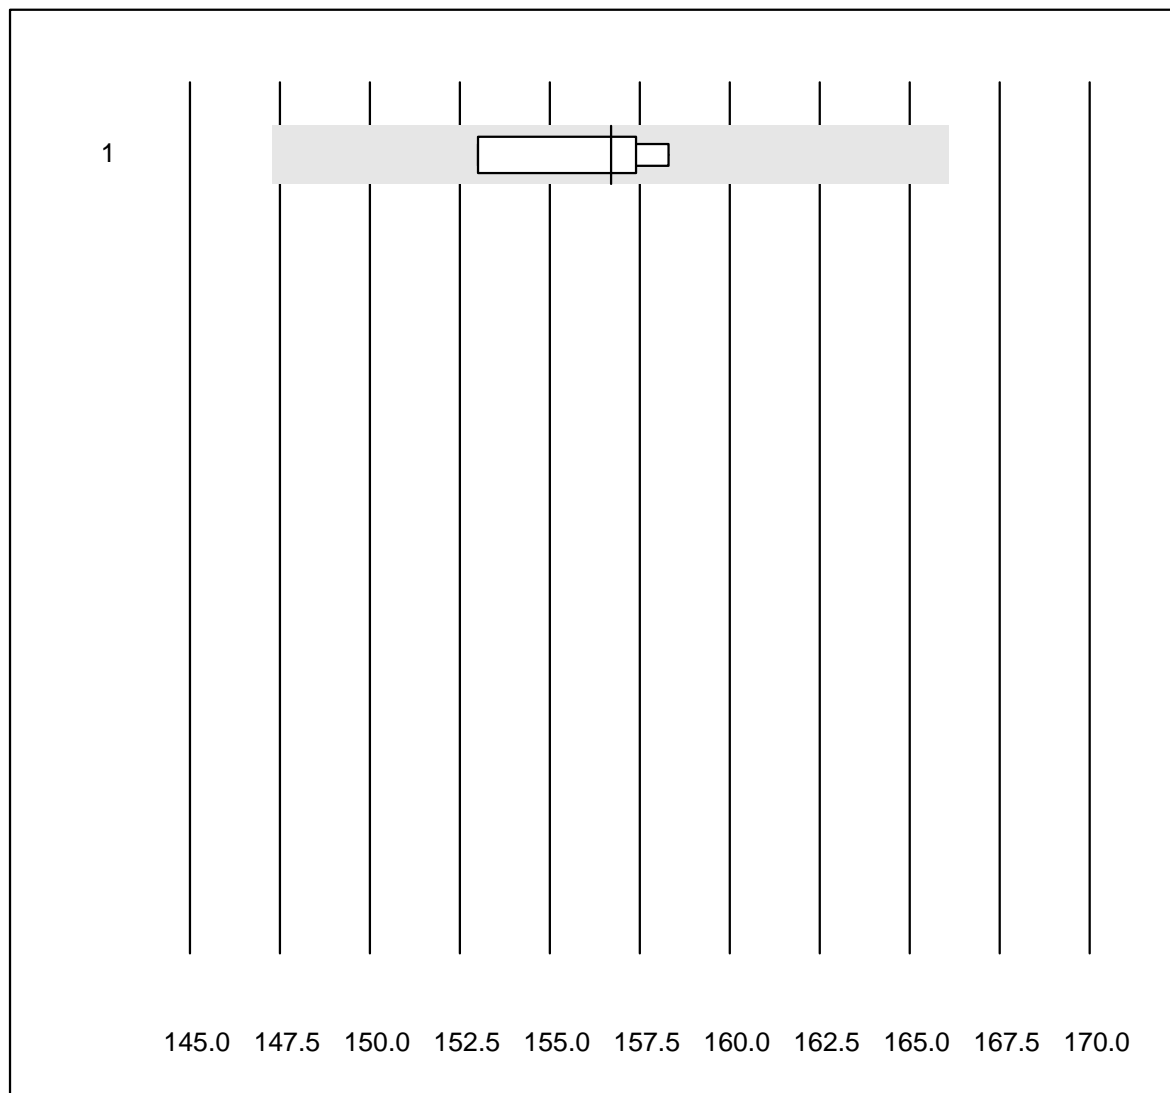


Tolérance QUALAB : 6 %

Sodium CCA (mmol/l)


No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 OPTI CCA	4	100.0	0.0	0.0	156.7	1.5	e*

Ferritine

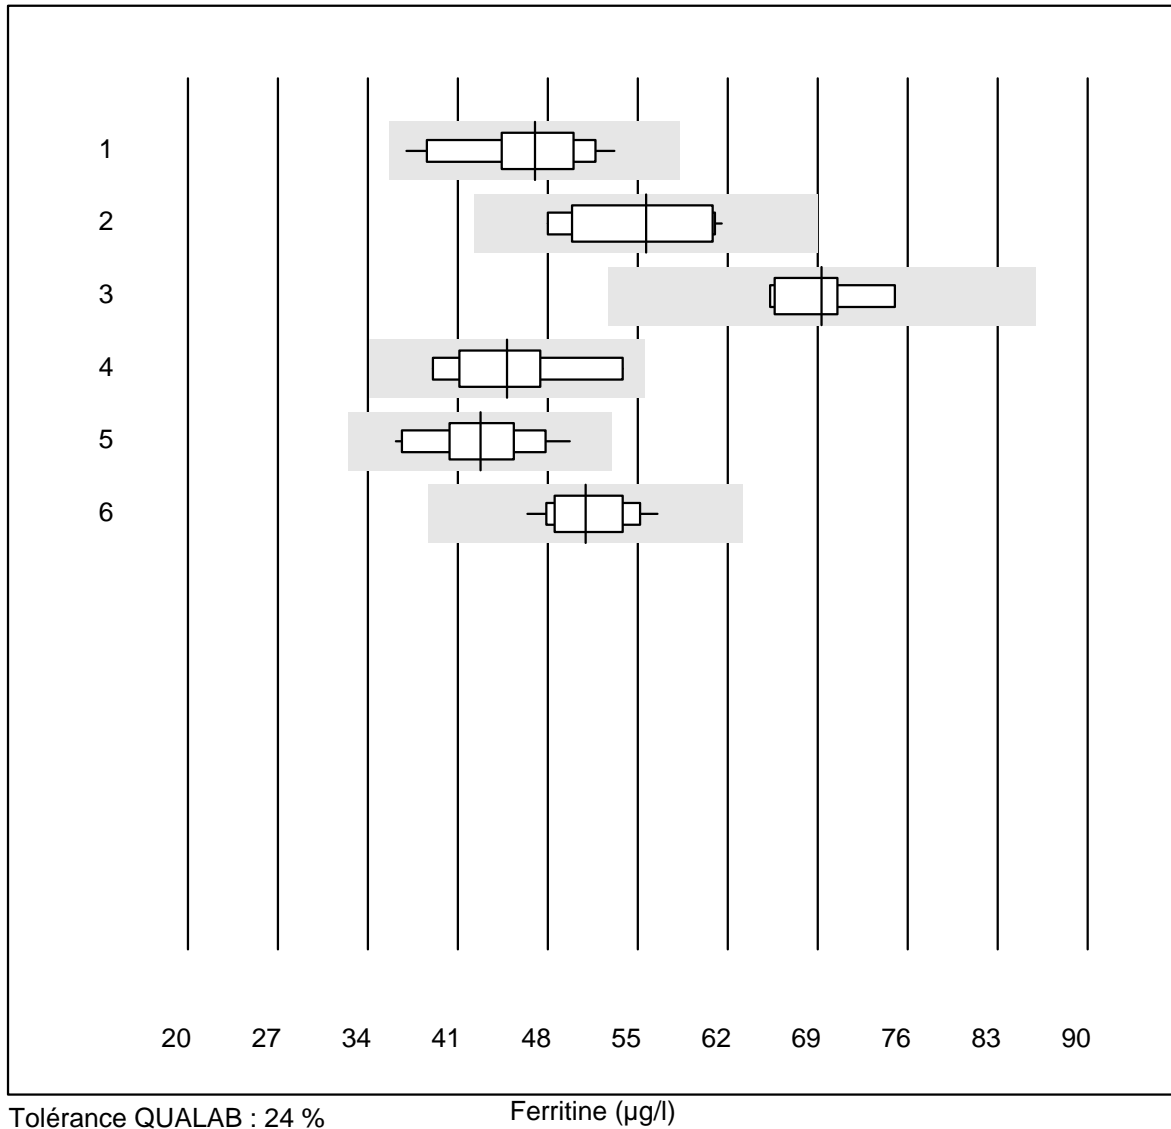

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Beckman	16	100.0	0.0	0.0	47.01	9.7	e
2 Cobas E / Elecsys	10	100.0	0.0	0.0	55.64	10.1	e*
3 Architect	5	100.0	0.0	0.0	69.30	5.7	e
4 Mini Vidas	7	100.0	0.0	0.0	44.80	10.7	e*
5 AFIAS	25	100.0	0.0	0.0	42.76	8.7	e
6 Eurolyser	18	94.4	0.0	5.6	50.94	5.8	e

Vitamine B12

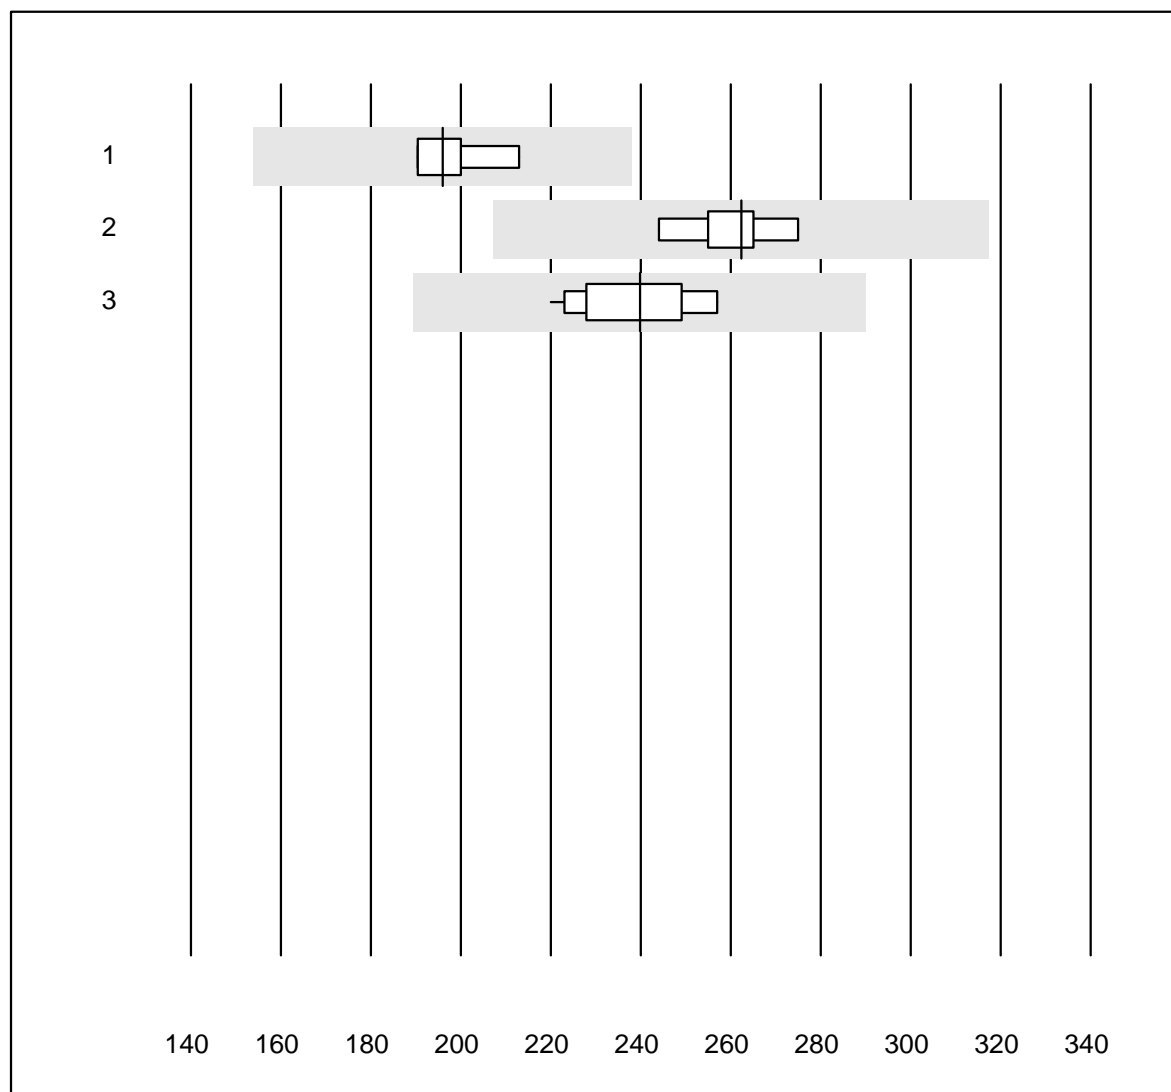


Tolérance QUALAB : 21 %
 (< 200.00: +/- 42.00 pmol/l)

Vitamine B12 (pmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	196.00	5.2	e*
2	Cobas E / Elecsys	8	100.0	0.0	0.0	262.40	3.7	e
3	Architect	11	100.0	0.0	0.0	239.80	5.3	e

Folate

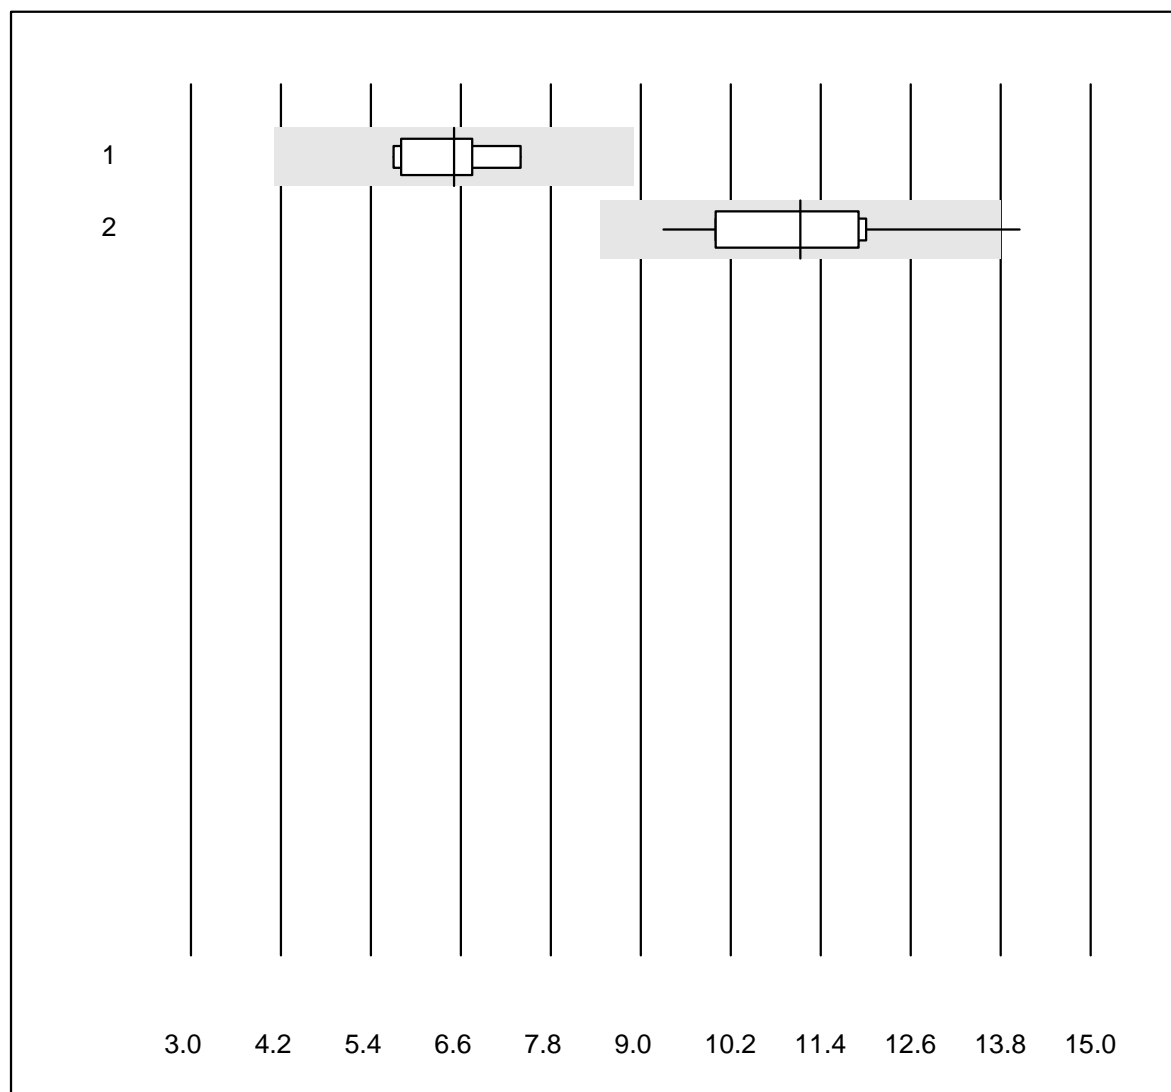


Tolérance QUALAB : 24 %
 (< 10.00: +/- 2.40 nmol/l)

Folate (nmol/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	8	100.0	0.0	0.0	6.51	9.5	e*
2	Architect	11	90.9	9.1	0.0	11.13	11.6	e*

Holotranscobalamine

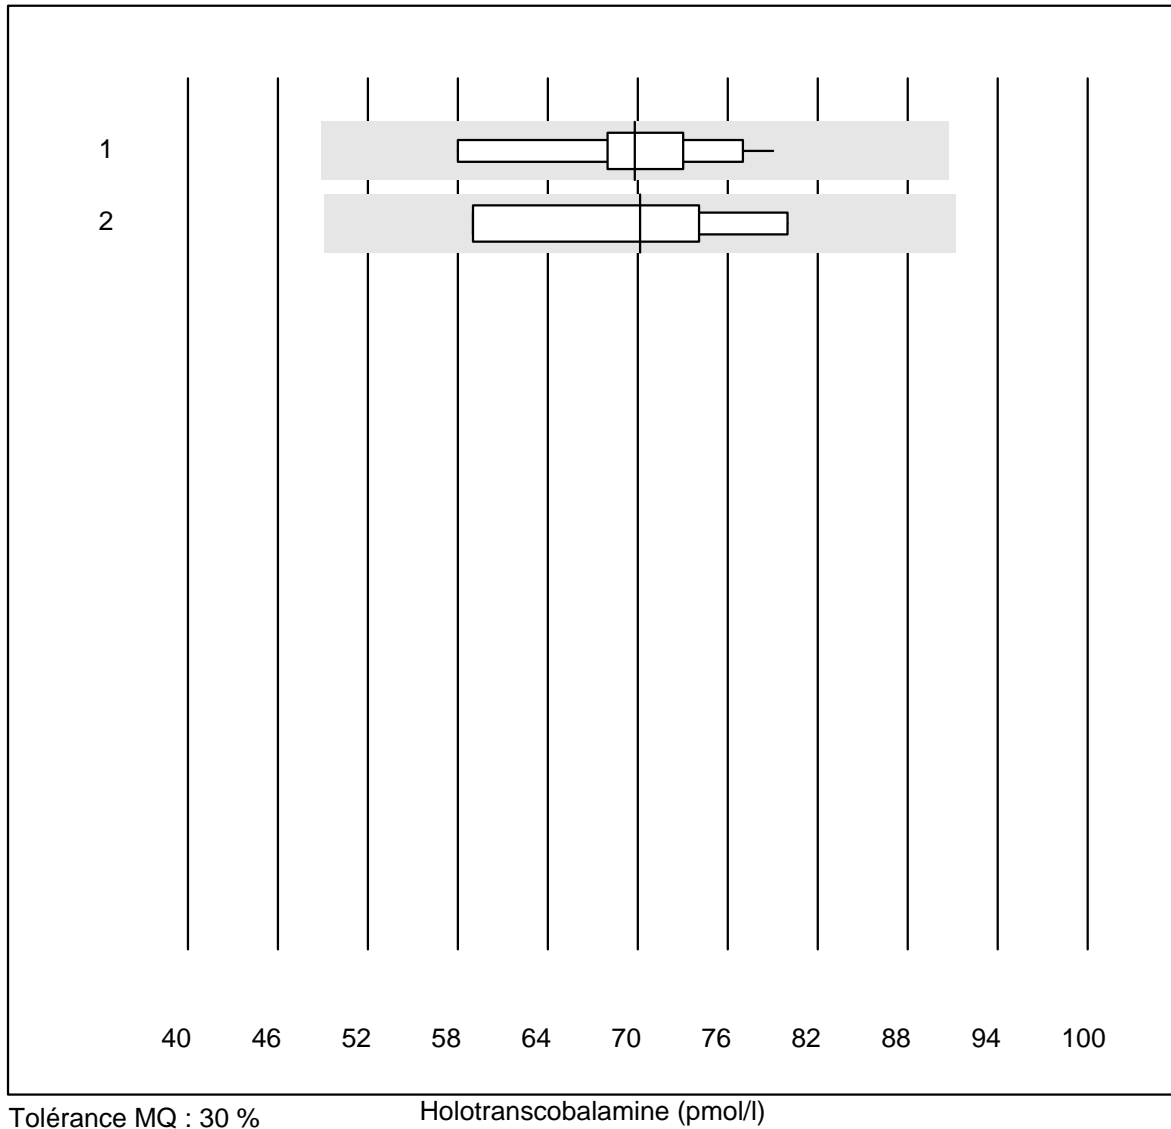

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Architect	10	100.0	0.0	0.0	70	9.3	e
2	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	70	13.1	e*


Bilirubin totale Neo

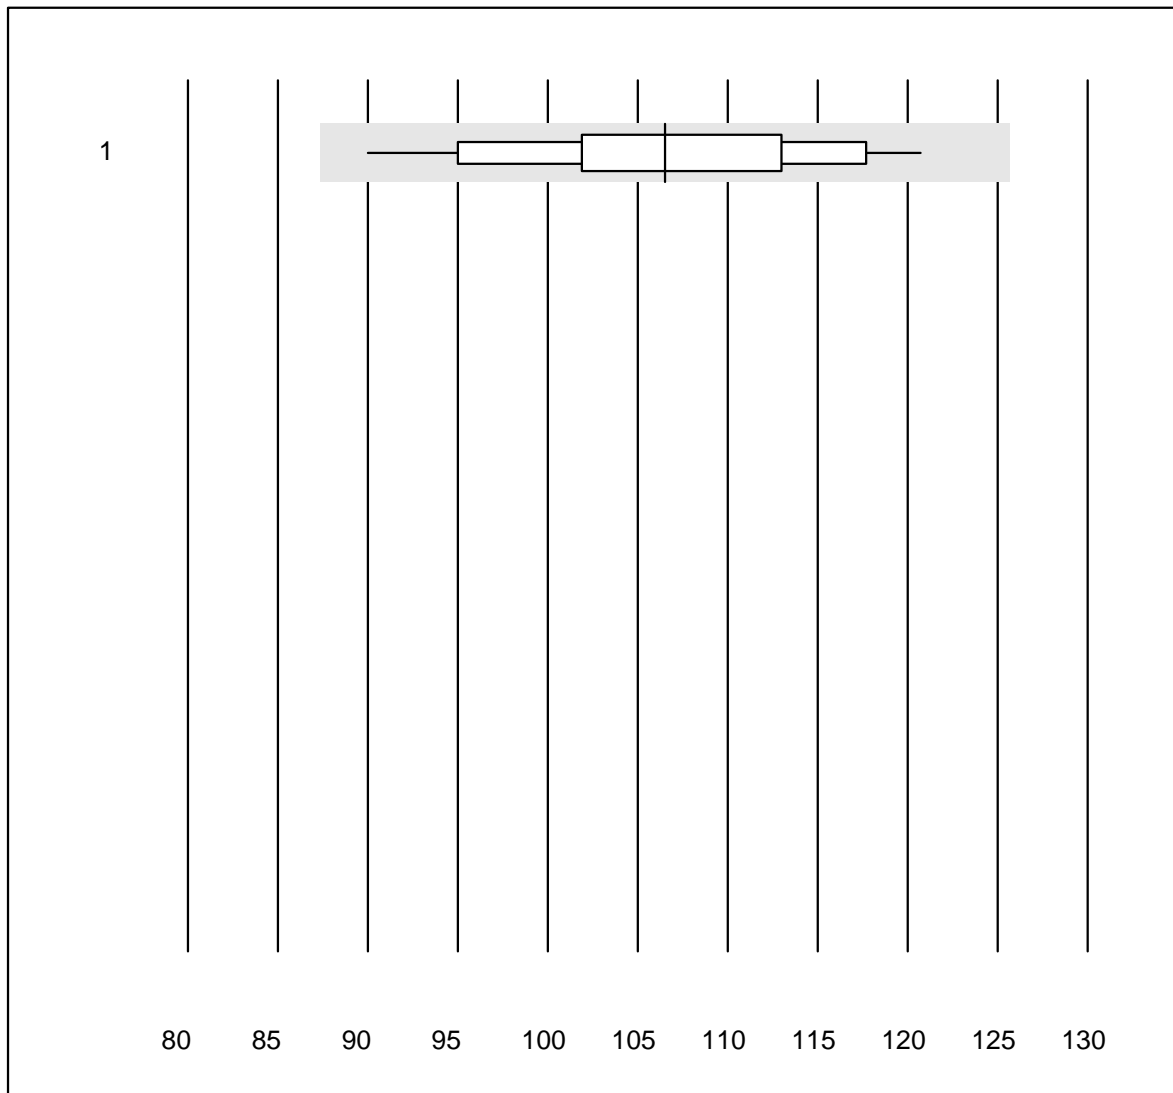

Tolérance QUALAB : 18 % Bilirubin totale Neo ($\mu\text{mol/l}$)

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 toutes les méthodes	18	100.0	0.0	0.0	107	7.4	e

Bilirubin directe

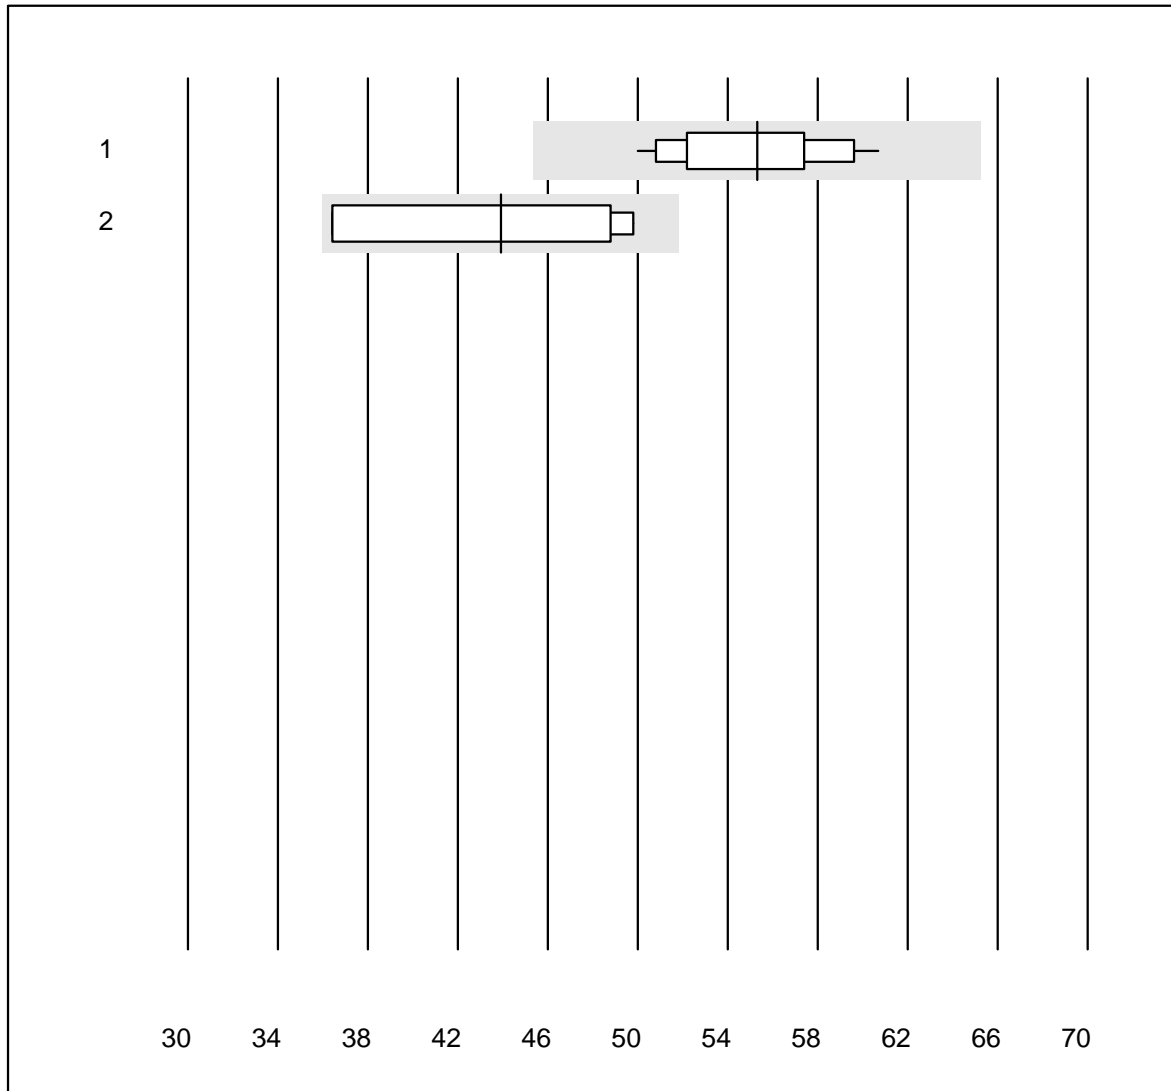


Tolérance QUALAB : 18 %

Bilirubin directe (µmol/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	15	100.0	0.0	0.0	55	6.0	e
2	Dimension	4	100.0	0.0	0.0	44	15.6	e*

Bilirubin néonatale

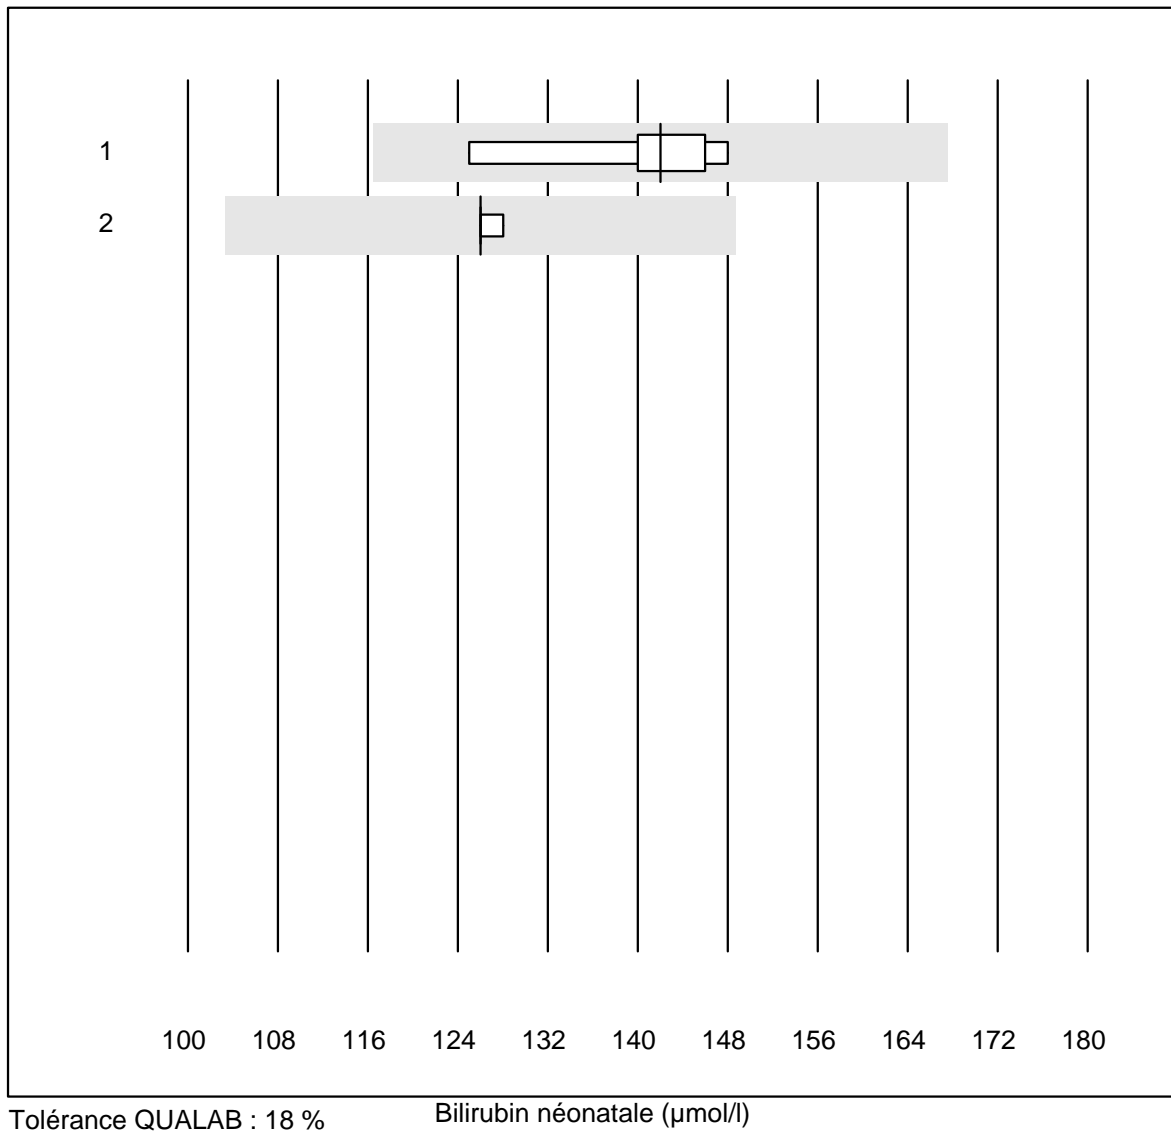


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	142	5.3	e
2	ABL700/800	4	100.0	0.0	0.0	126	0.8	e

PSA

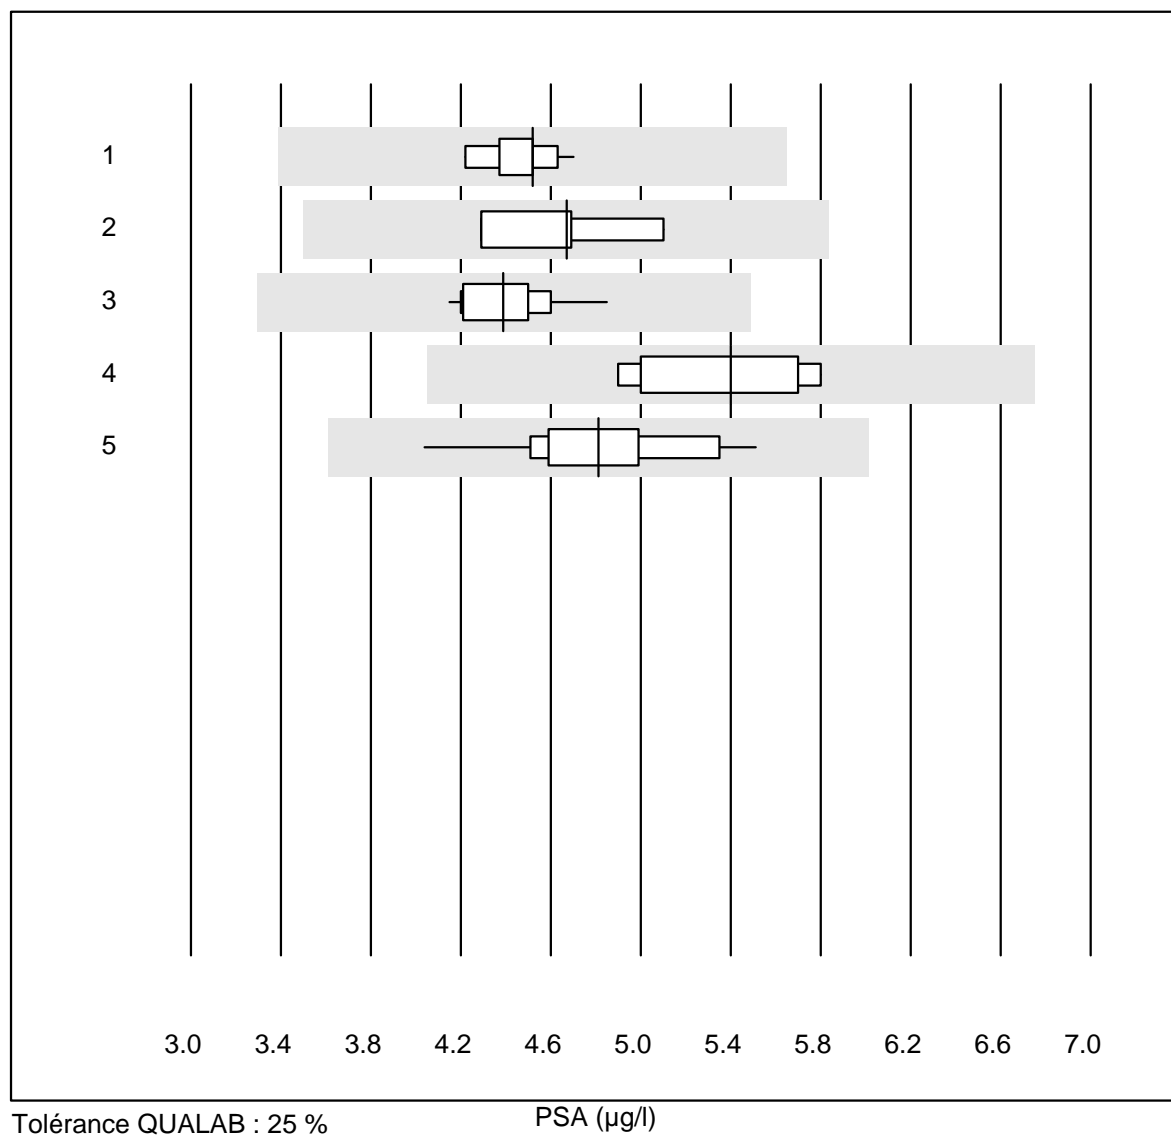


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	10	100.0	0.0	0.0	4.52	3.3	a
2 VIDAS	4	100.0	0.0	0.0	4.67	7.1	e*
3 Architect	11	100.0	0.0	0.0	4.39	4.7	e
4 Qualigen	5	100.0	0.0	0.0	5.40	7.5	e*
5 AFIAS	18	100.0	0.0	0.0	4.81	7.3	e

PSA frei

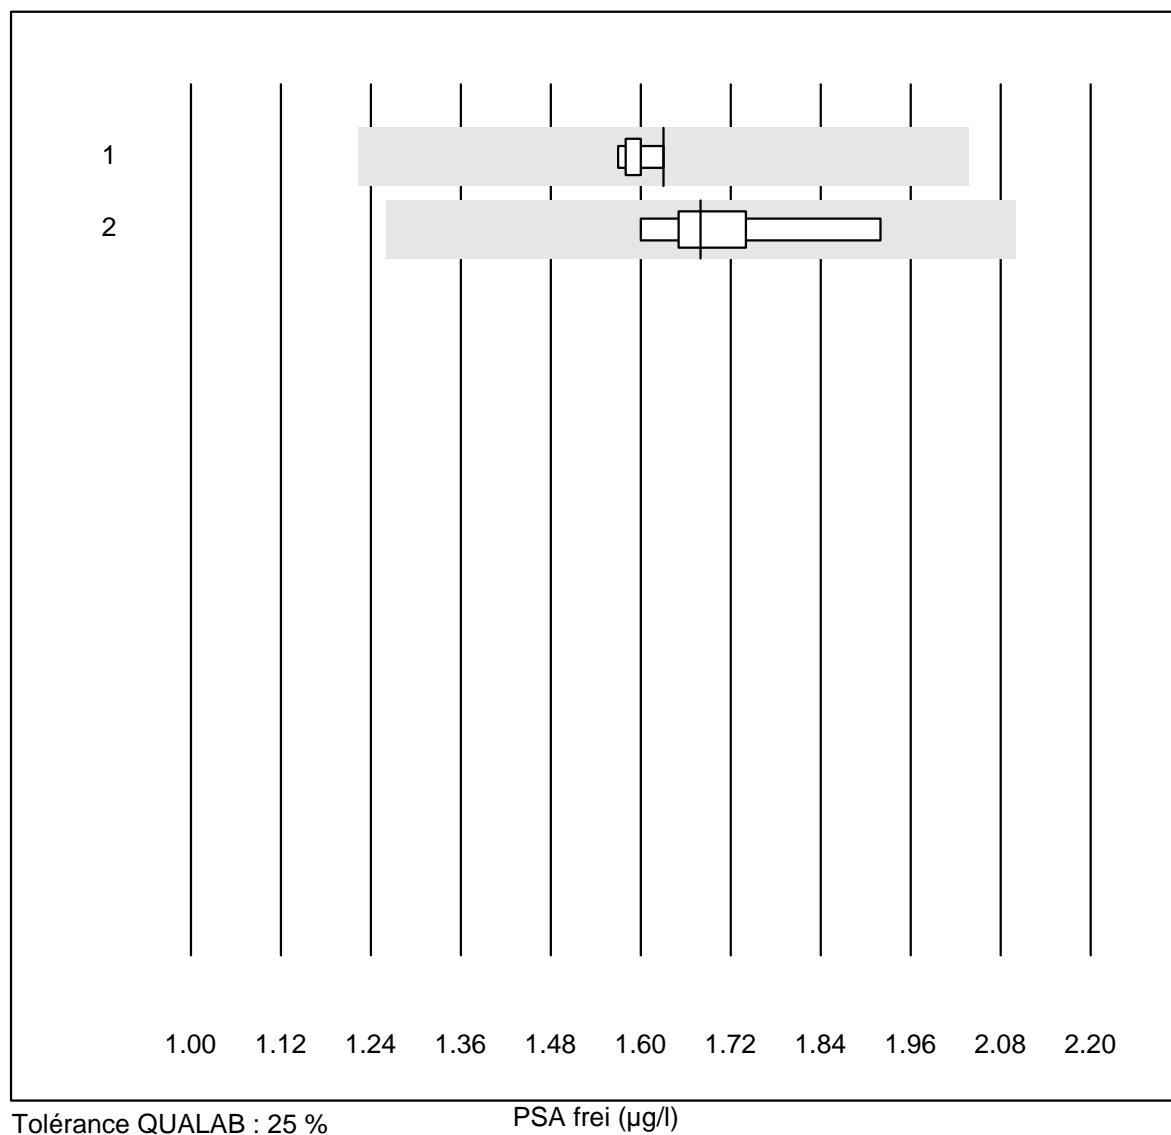


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	6	100.0	0.0	0.0	1.63	1.3	a
2	Architect	9	100.0	0.0	0.0	1.68	5.5	a

CEA

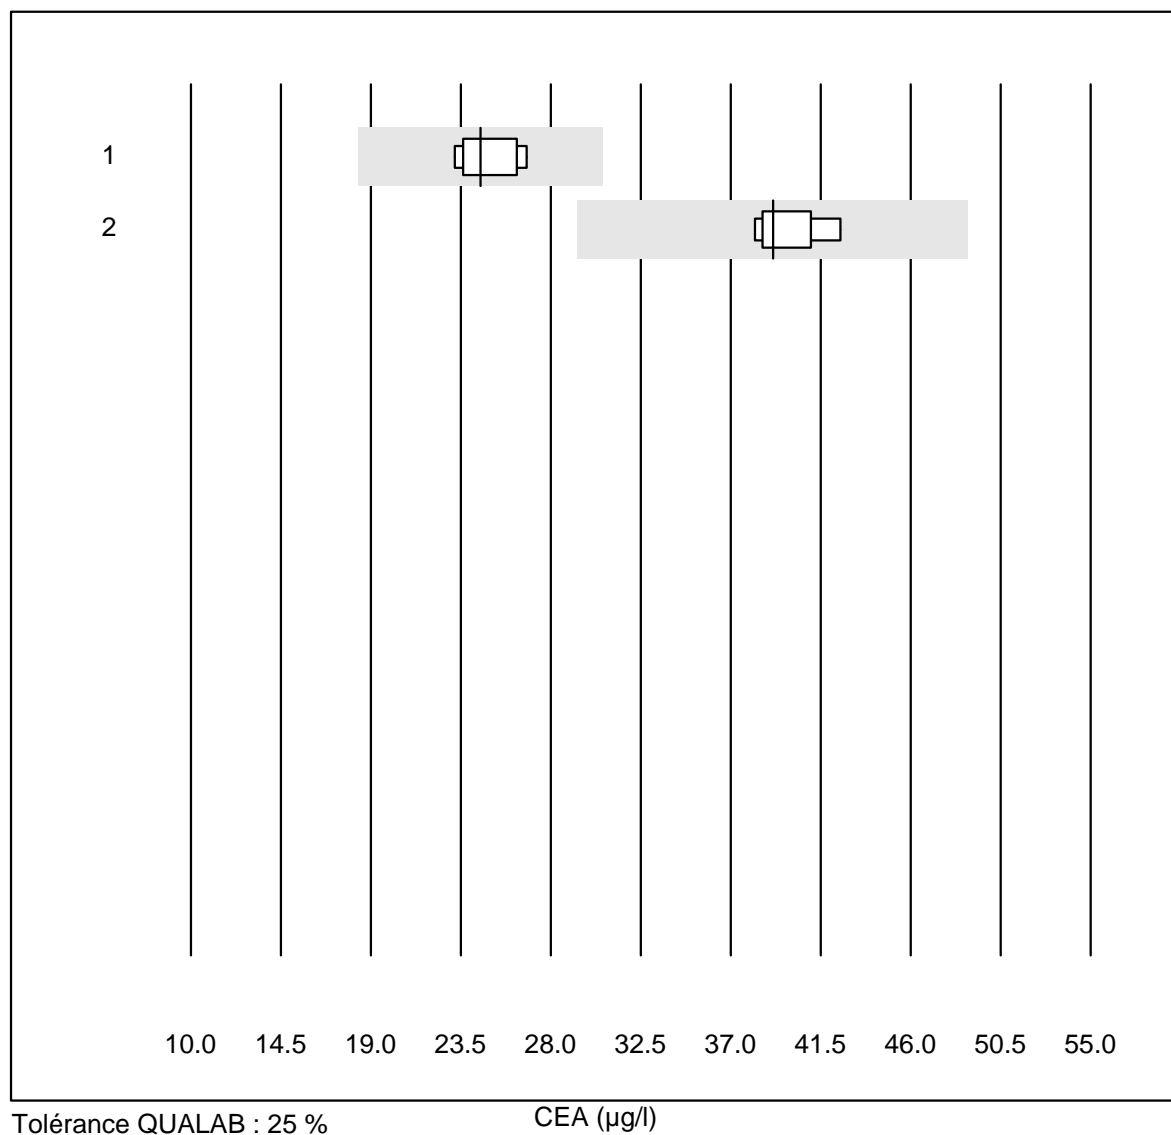

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	7	100.0	0.0	0.0	24.5	5.7	a
2	Architect	9	100.0	0.0	0.0	39.1	3.7	a

CA 125

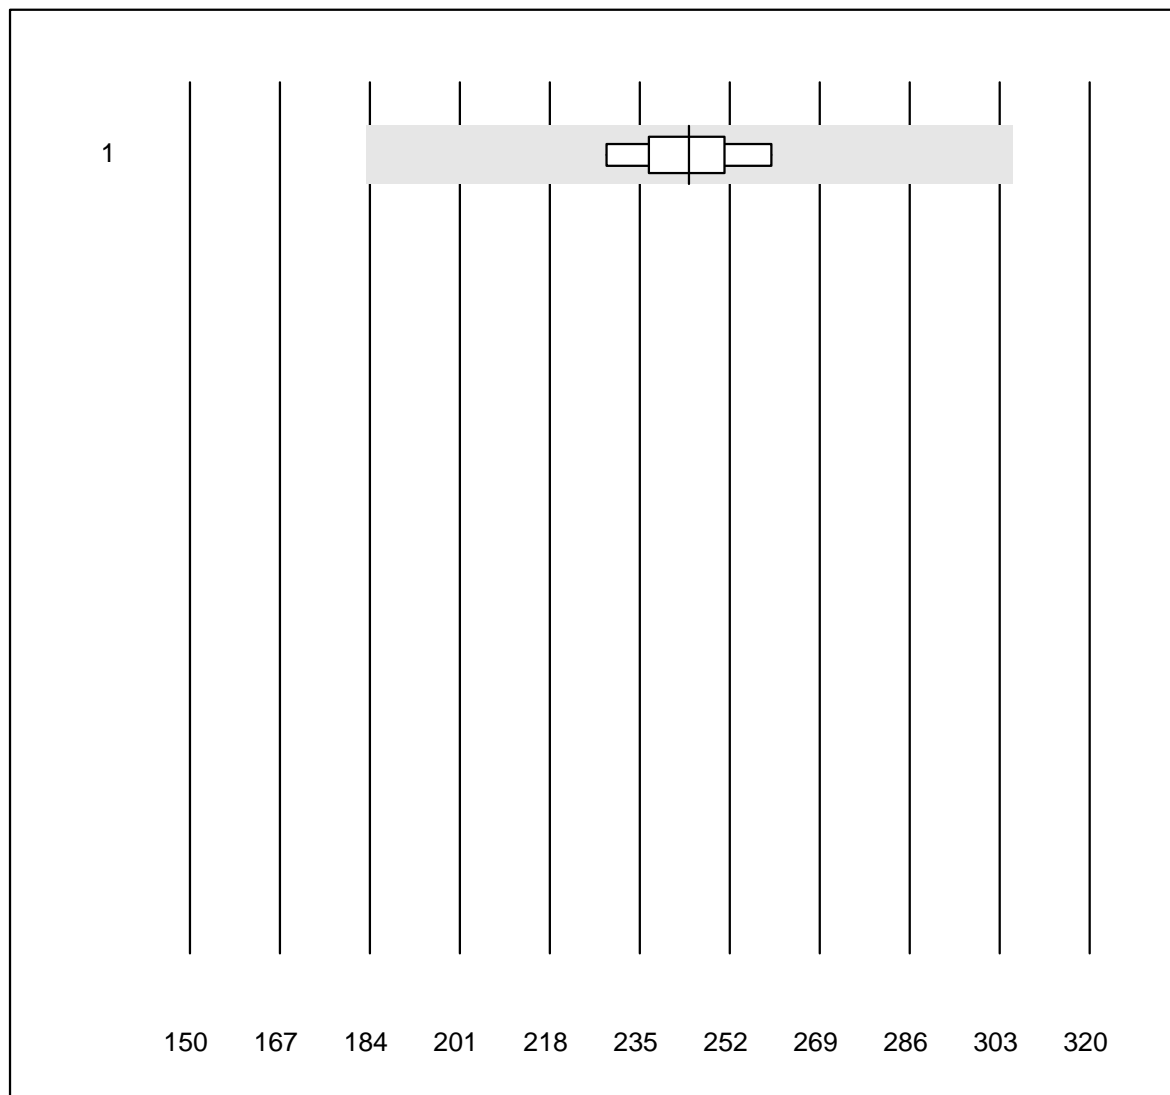


Tolérance MQ : 25 %

CA 125 (kIU/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Architect	6	100.0	0.0	0.0	244.4	4.4	e

CA 19-9

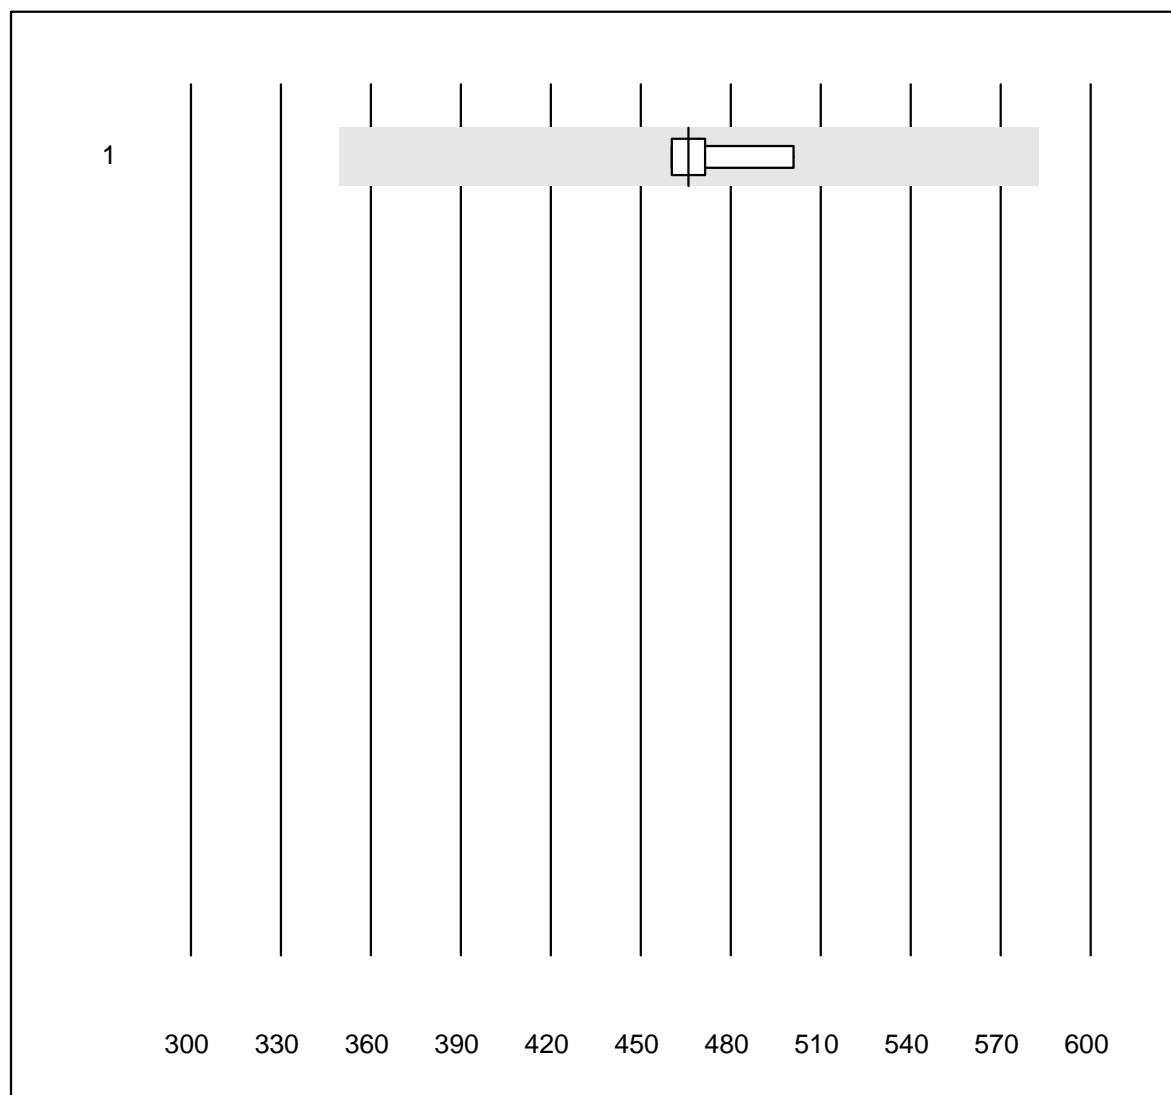


Tolérance MQ : 25 %

CA 19-9 (kIU/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Architect	4	100.0	0.0	0.0	466.0	3.9	a

CA 15-3

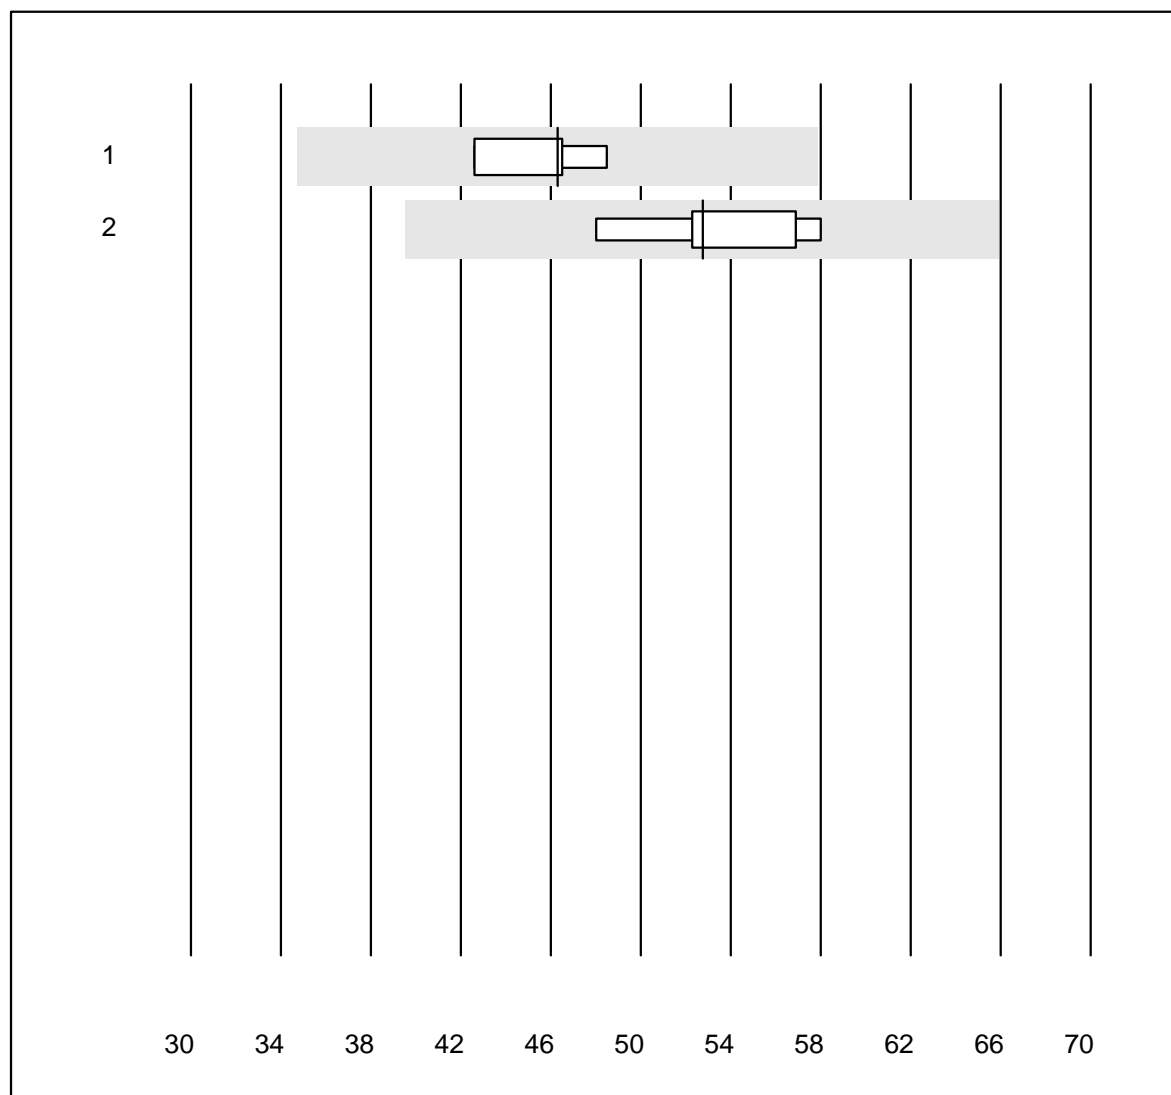


Tolérance MQ : 25 %

CA 15-3 (kIU/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	4	100.0	0.0	0.0	46.3	5.8	a
2	Architect	6	100.0	0.0	0.0	52.8	6.7	e

AFP

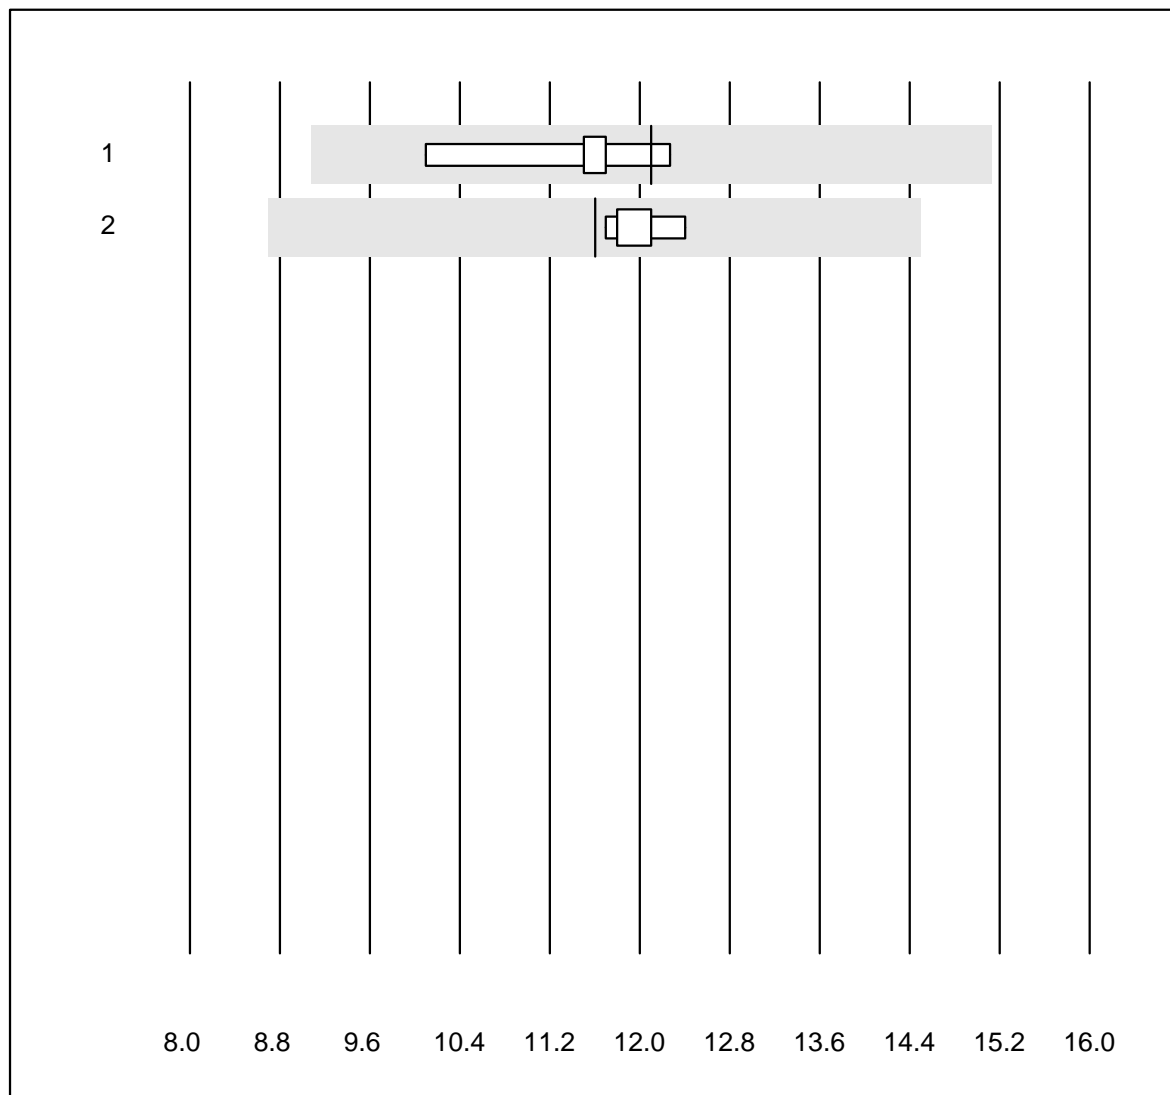


Tolérance QUALAB : 25 %

AFP (µg/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	5	100.0	0.0	0.0	12.1	7.1	a
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	11.6	2.3	a

HCG qn

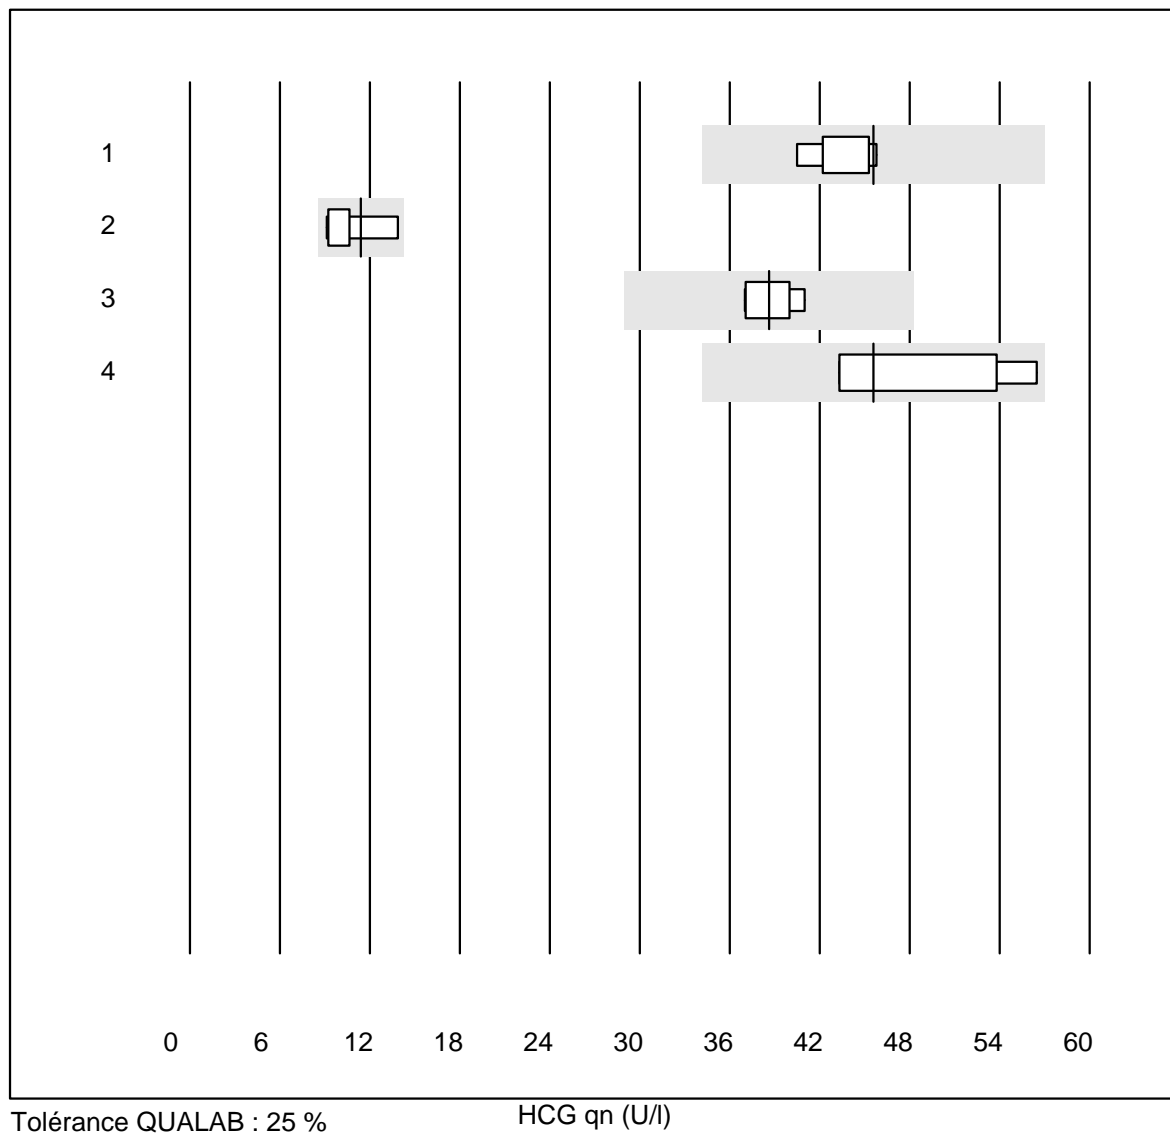

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	6	100.0	0.0	0.0	45.6	4.7	a
2	VIDAS	8	100.0	0.0	0.0	11.4	15.5	a
3	Architect	5	100.0	0.0	0.0	38.6	4.6	a
4	AFIAS	4	100.0	0.0	0.0	45.6	11.5	a

HCG intakt

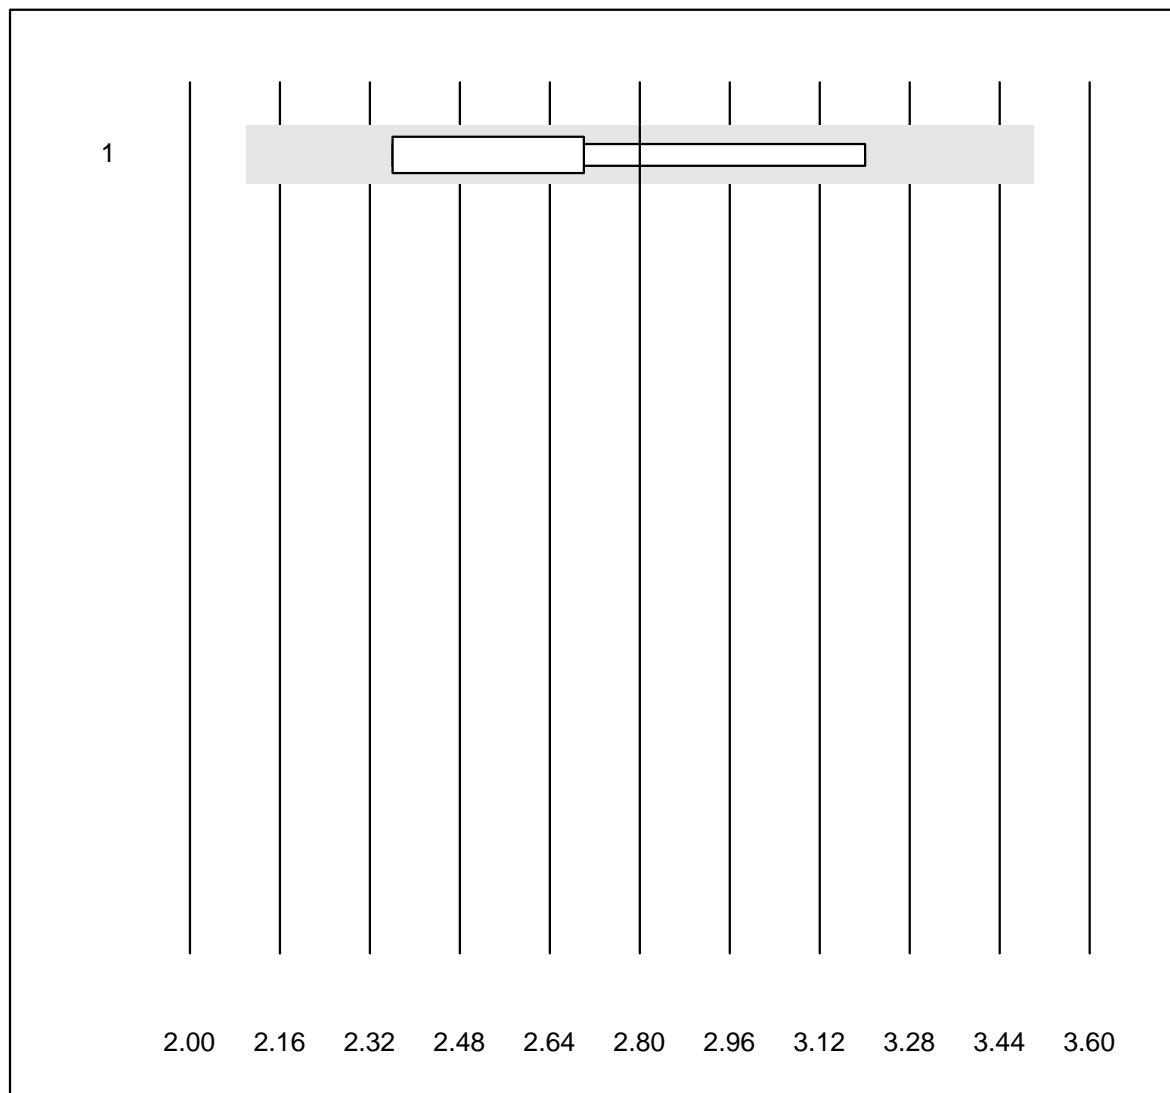


Tolérance QUALAB : 25 %

HCG intakt (U/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	2.8	13.0	a

CK-MB

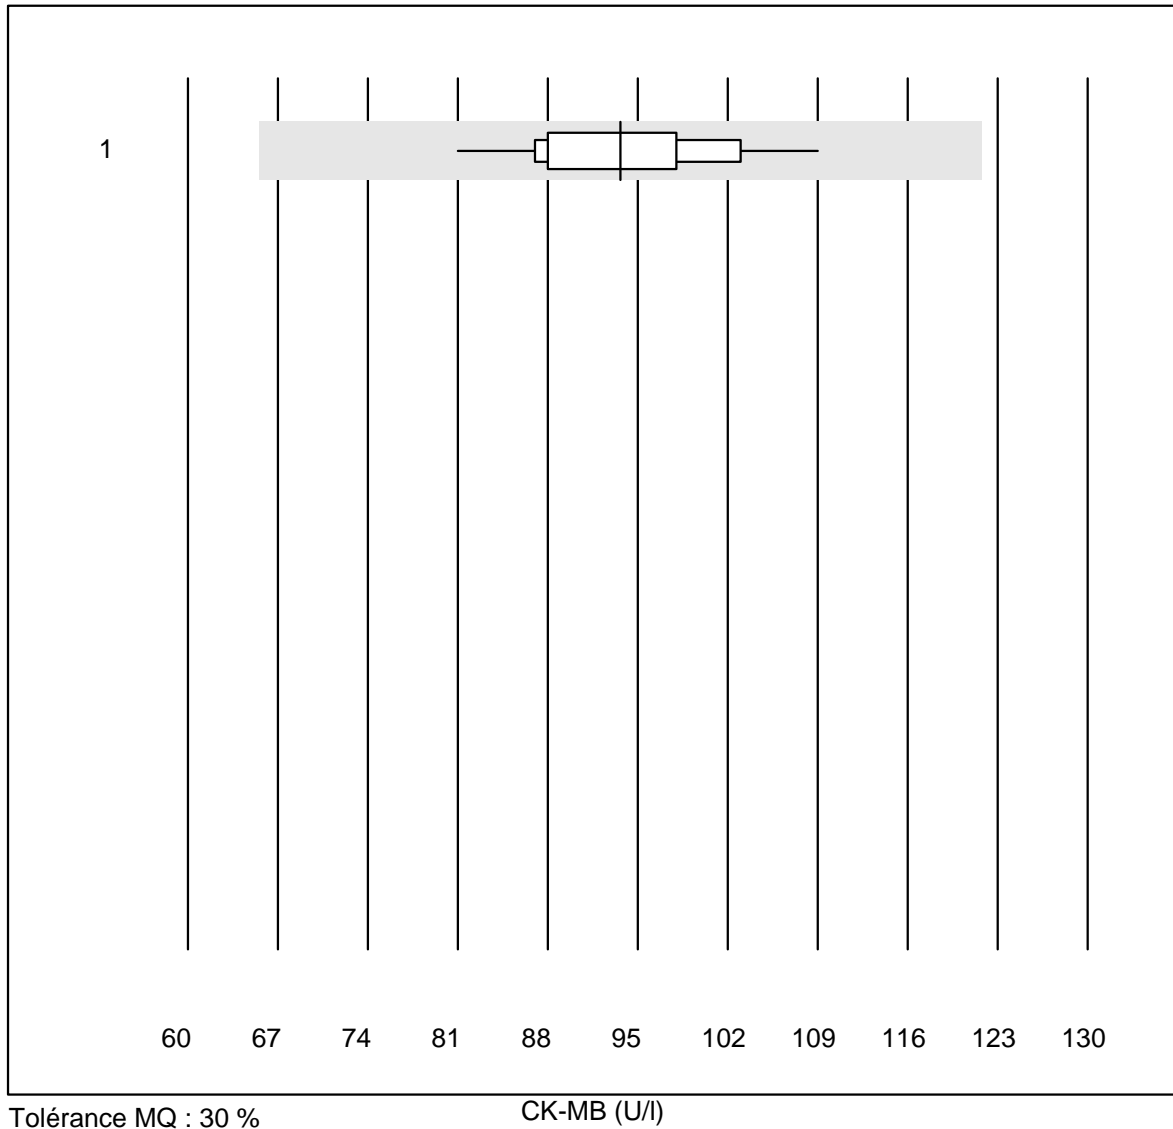

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Fuji Dri-Chem	33	93.9	0.0	6.1	93.6	7.6	e

BNP

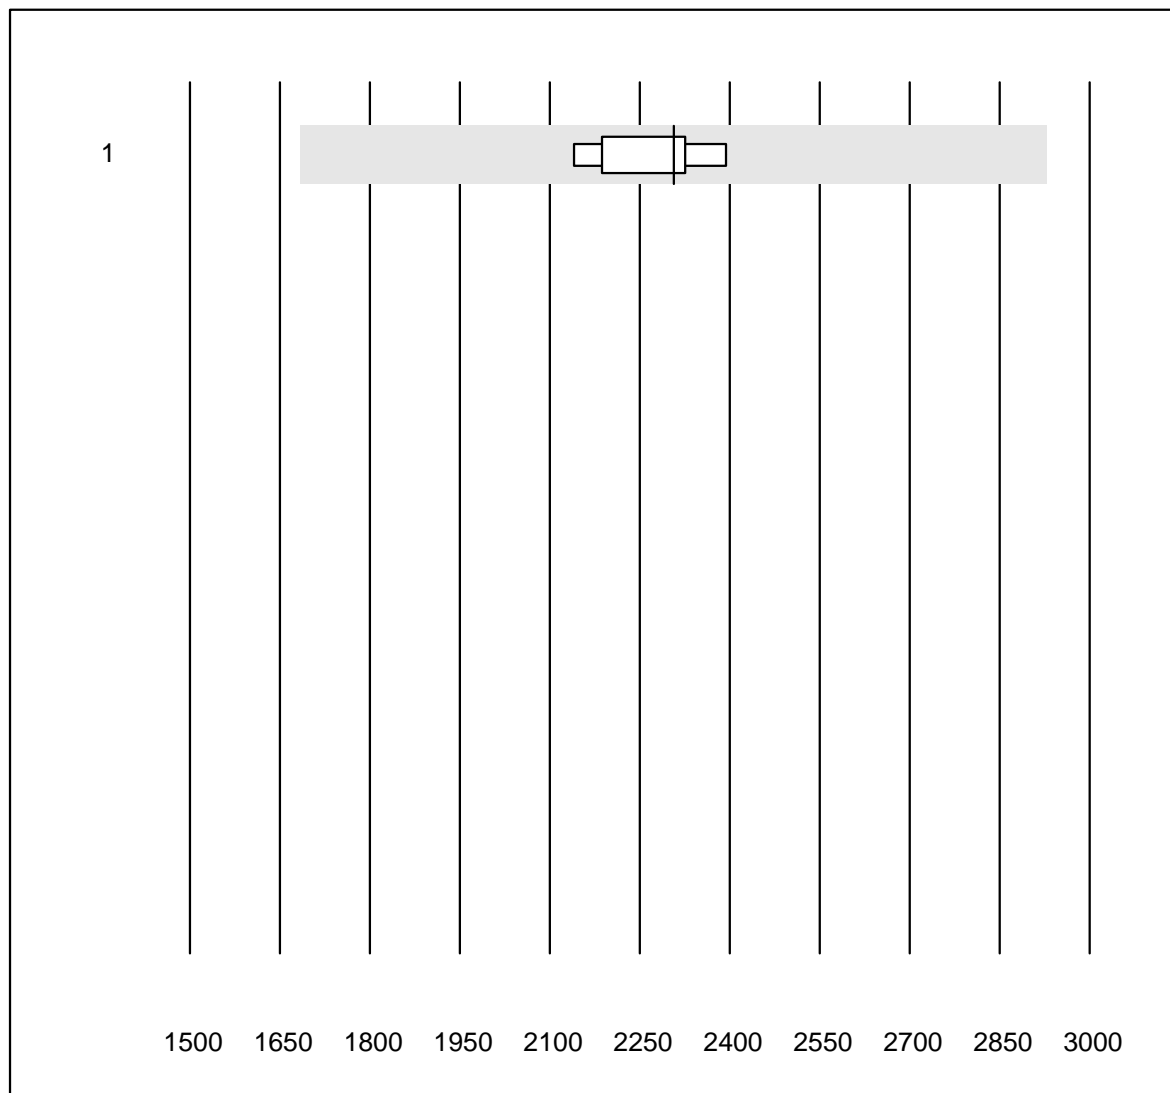


Tolérance QUALAB : 27 %

BNP (ng/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Architect	6	100.0	0.0	0.0	2306.6	4.2	e

NT-proBNP

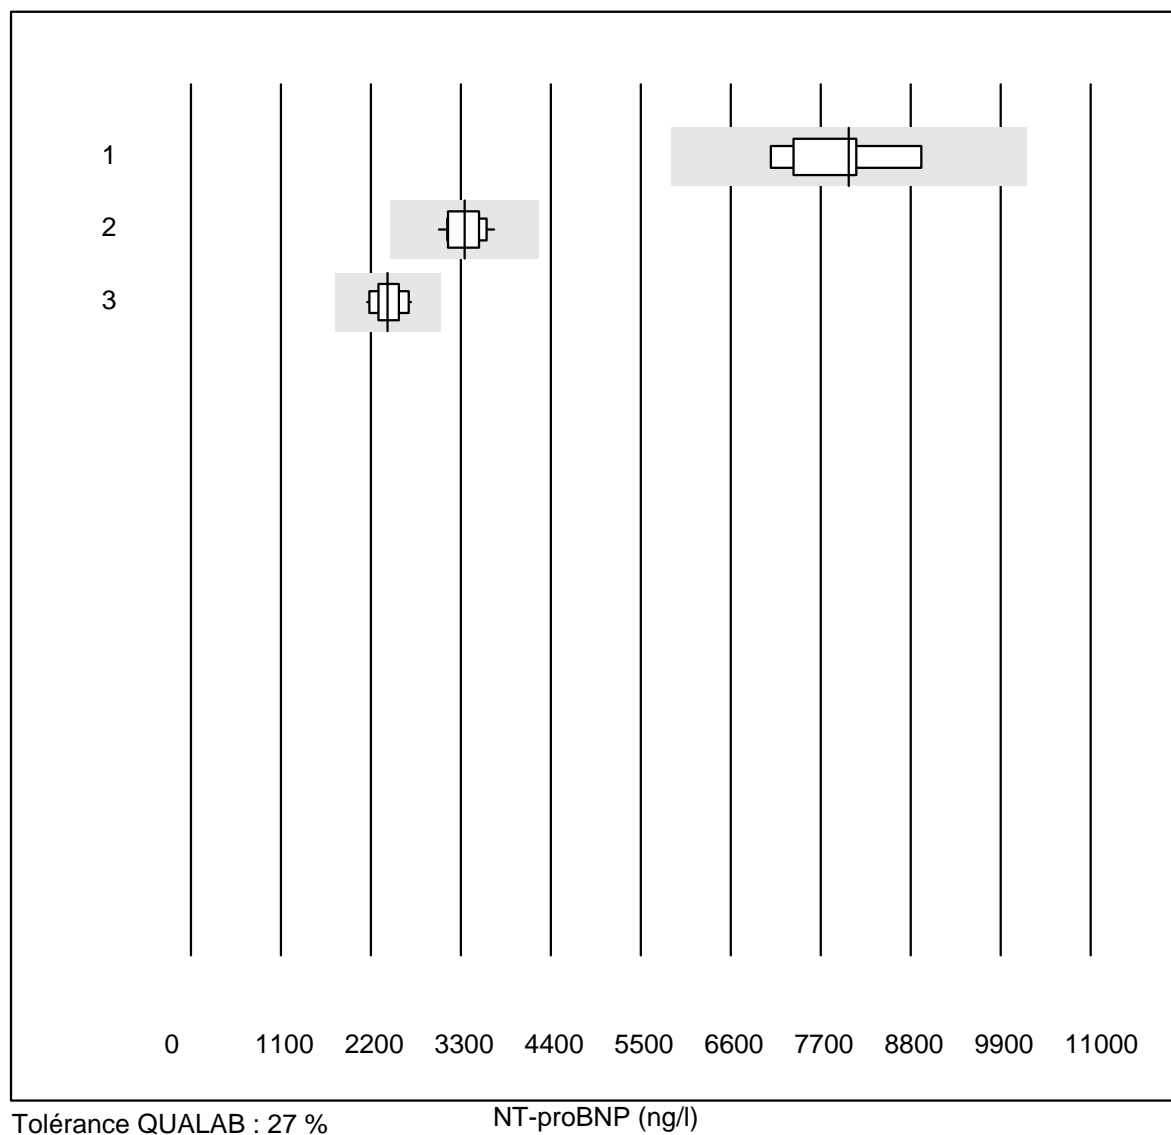

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 AQT 90 FLEX	6	100.0	0.0	0.0	8045.0	8.1	e*
2 VIDAS	11	100.0	0.0	0.0	3345.3	6.7	e
3 Cobas E / Elecsys	14	100.0	0.0	0.0	2401.7	7.3	e

Cholesterin PTS

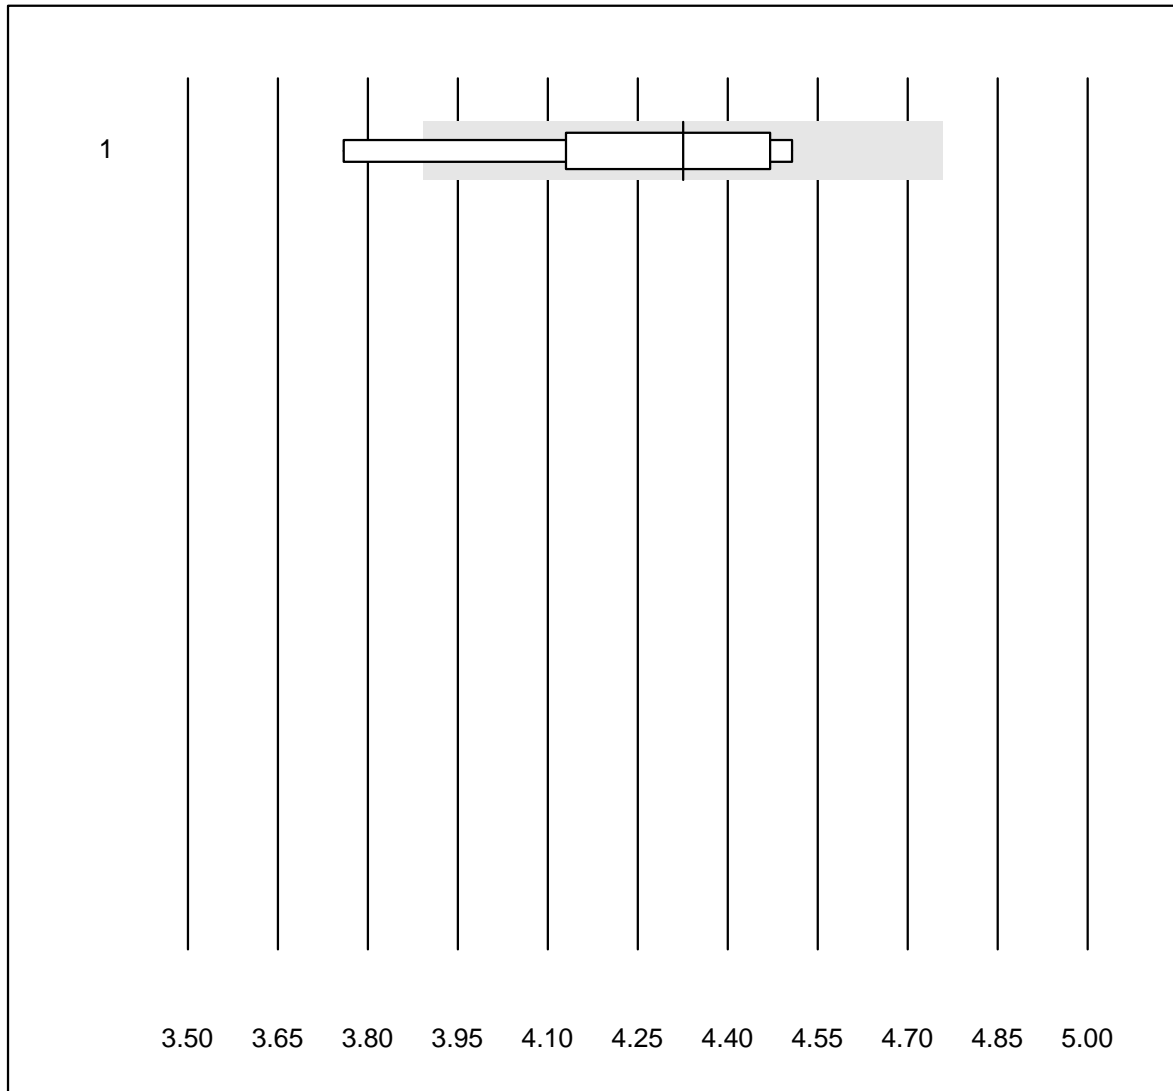


Tolérance QUALAB : 10 %

Cholesterin PTS (mmol/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 CardioChek	8	87.5	12.5	0.0	4.33	6.0	e*

Cholesterin HDL PTS

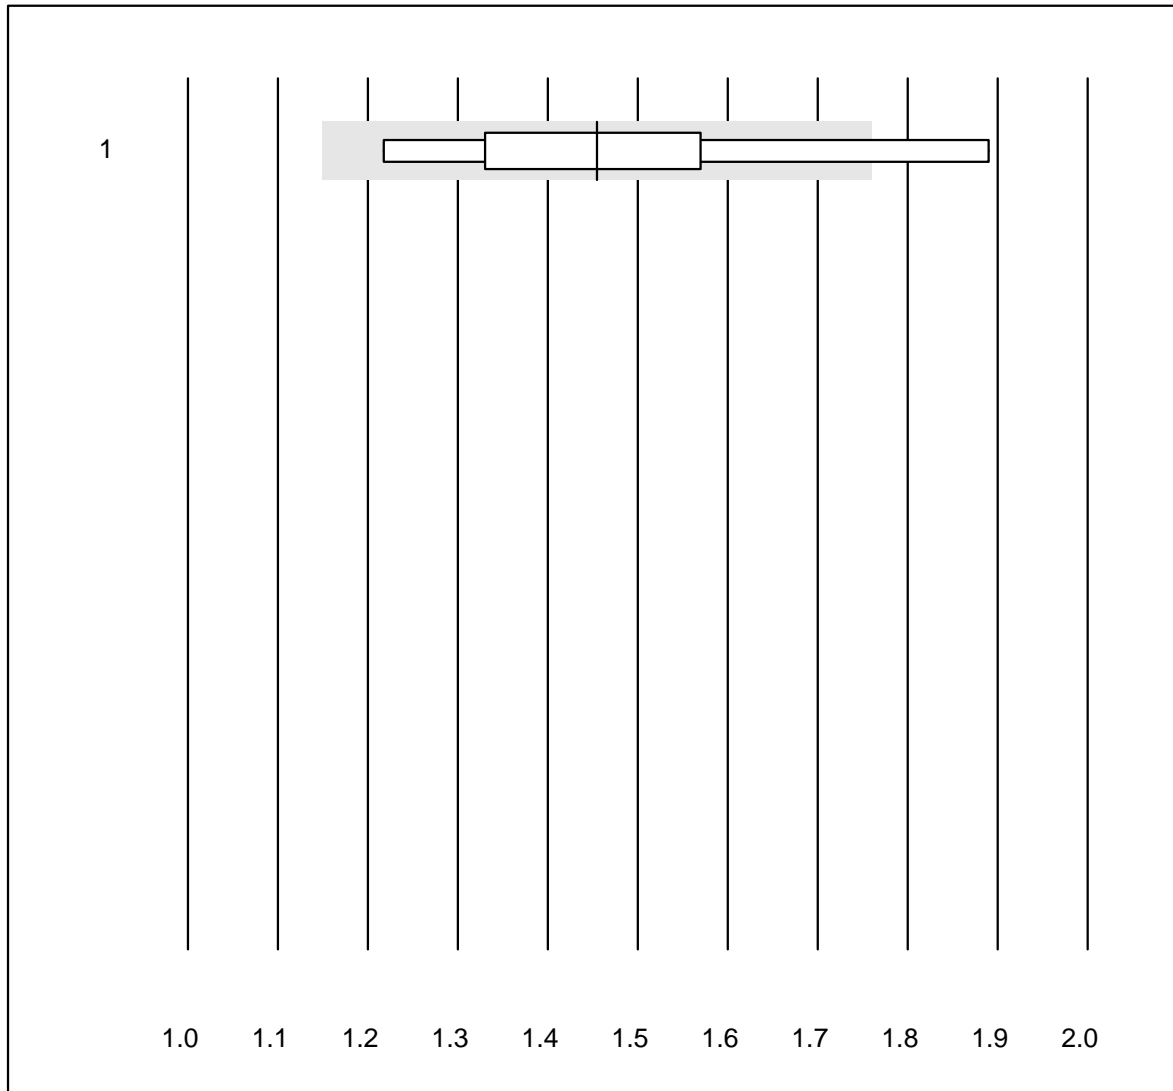


Tolérance QUALAB : 21 %

Cholesterin HDL PTS (mmol/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 CardioChek	8	75.0	25.0	0.0	1.46	15.3	e*

Triglyceride PTS

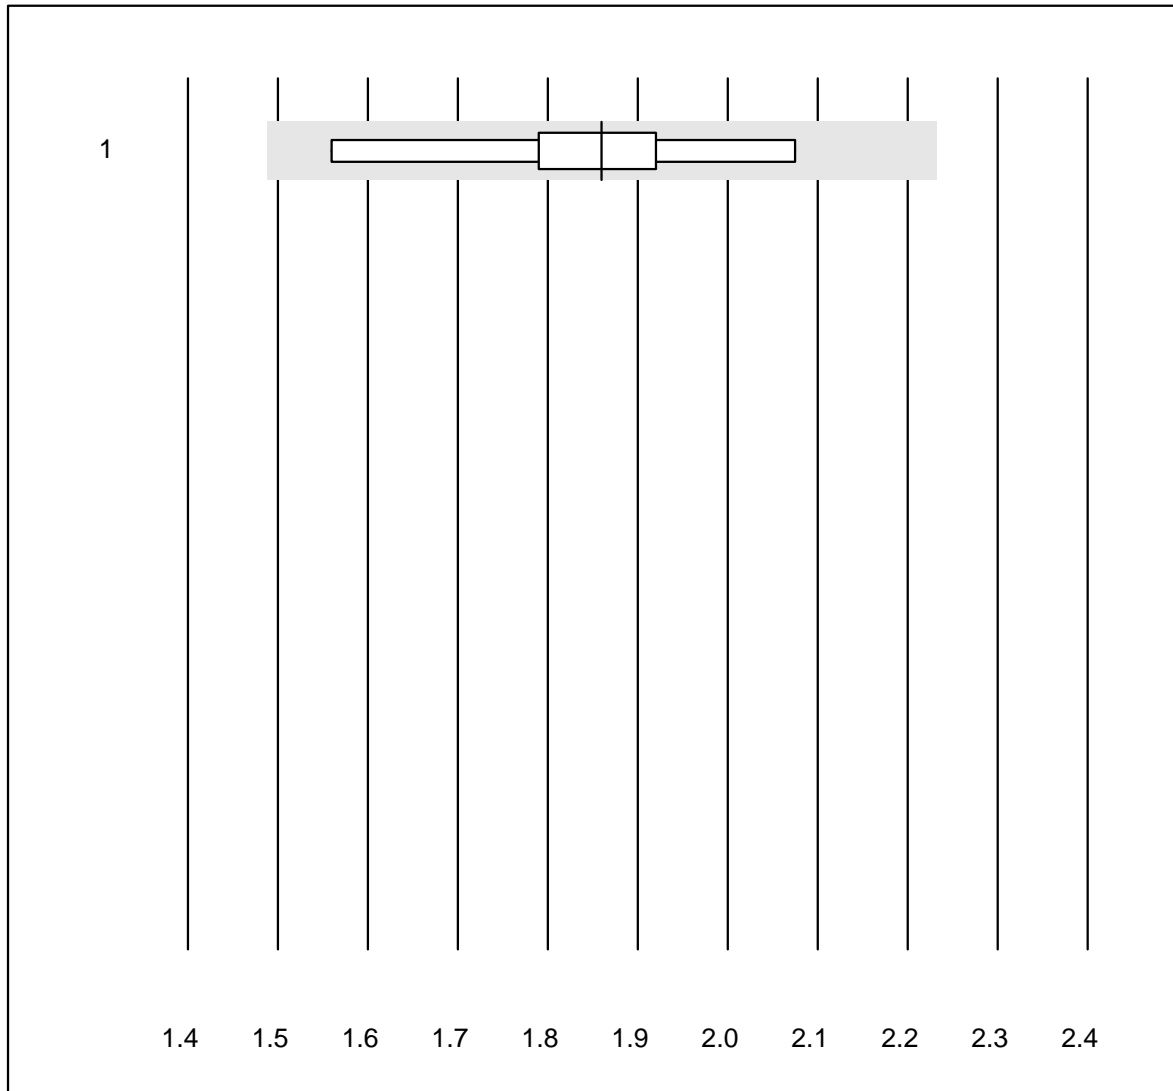


Tolérance QUALAB : 20 %

Triglyceride PTS (mmol/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 CardioChek	8	100.0	0.0	0.0	1.86	8.2	e*

C-Peptid

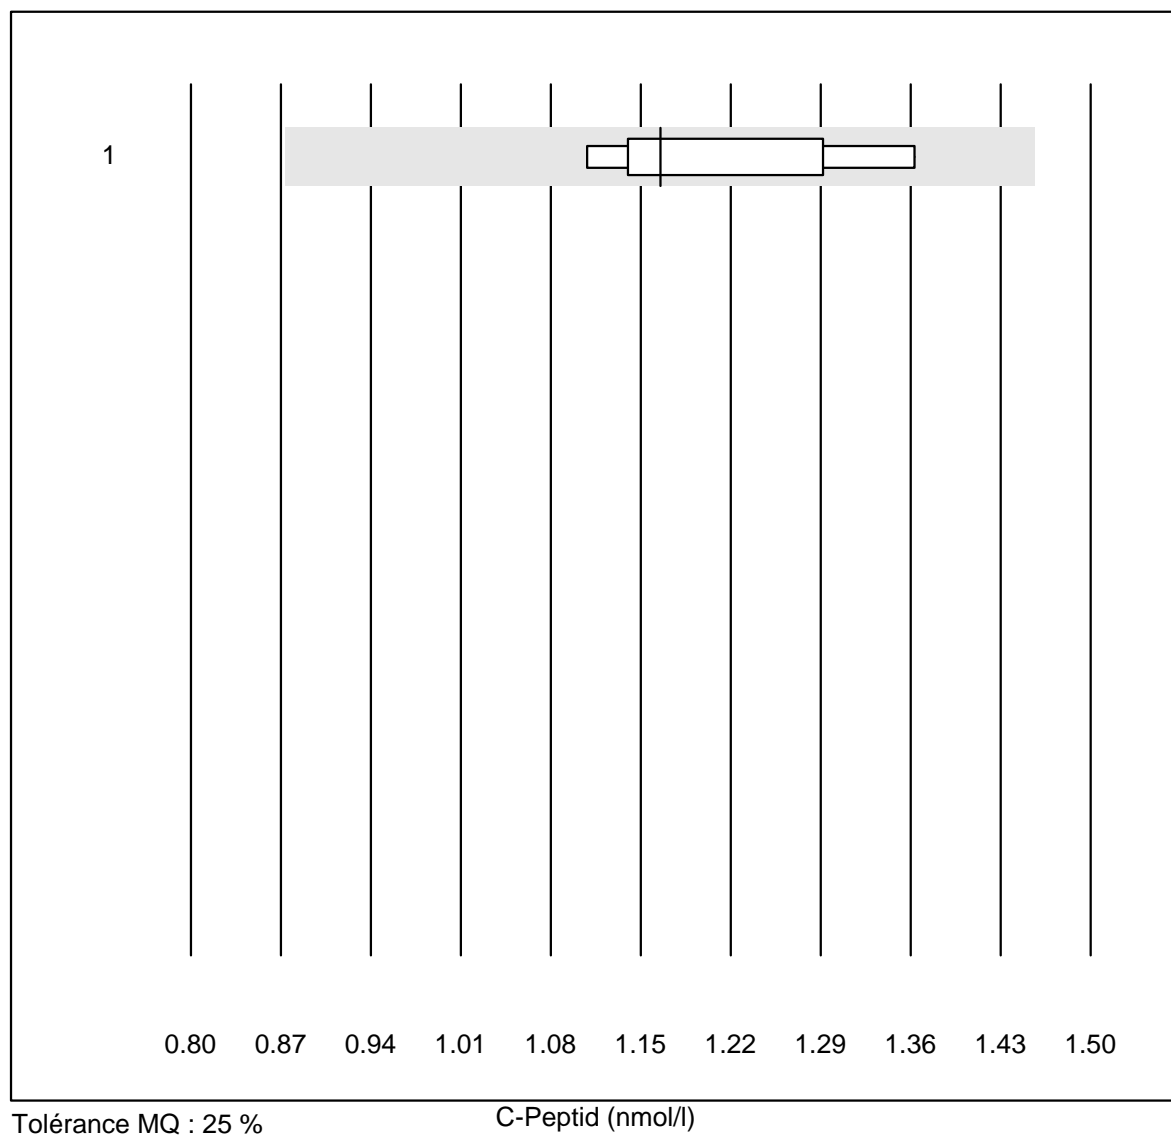

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	1.2	7.7	e

Procalcitonine

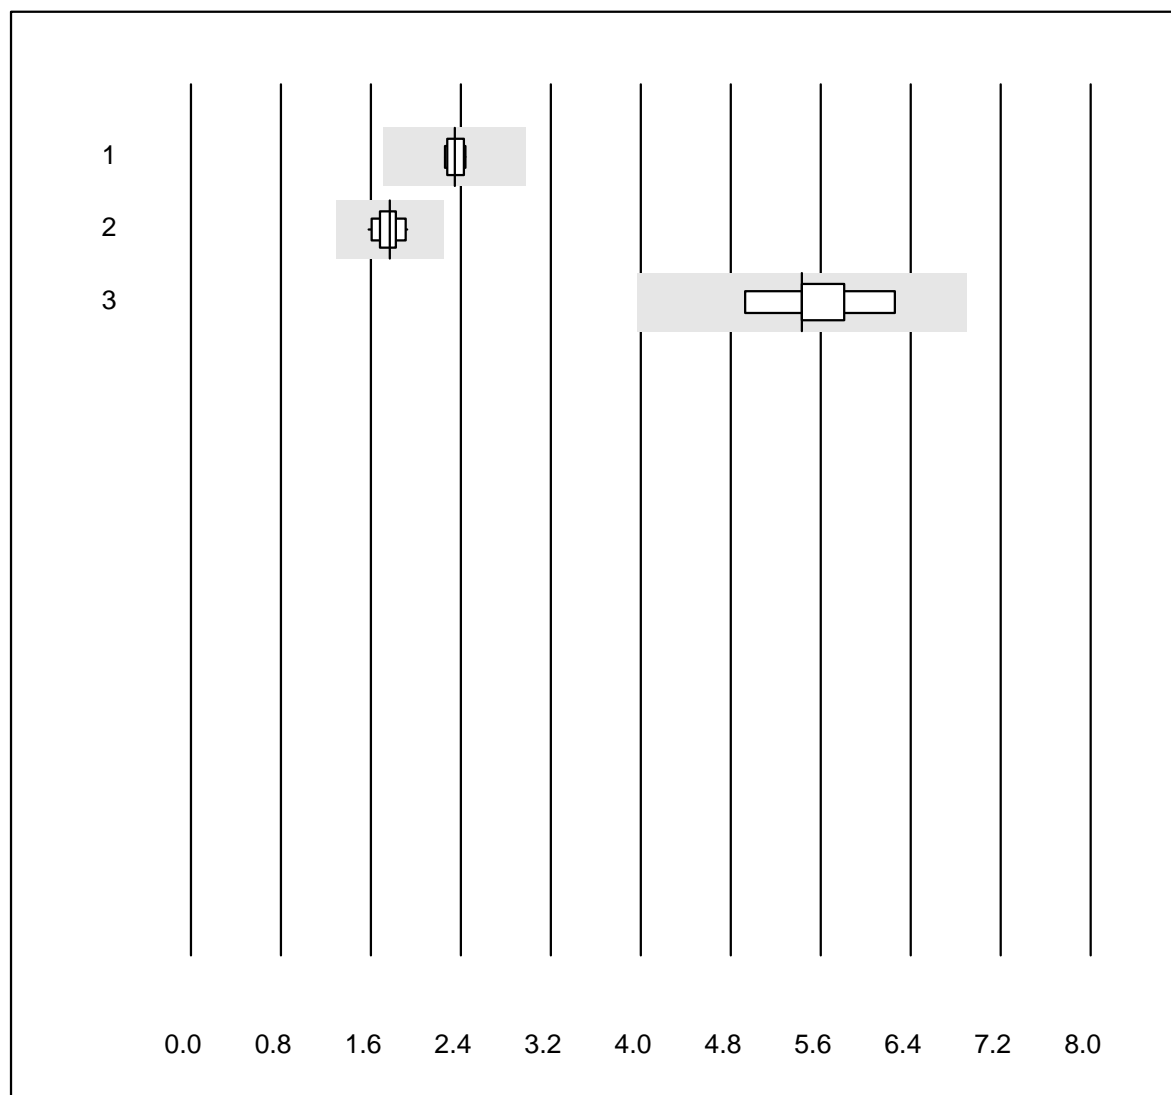


Tolérance QUALAB : 27 %

Procalcitonine (µg/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas	6	100.0	0.0	0.0	2.35	3.4	e
2 VIDAS	17	94.1	0.0	5.9	1.77	6.0	e
3 Liaison	5	100.0	0.0	0.0	5.43	8.9	e*

EPO

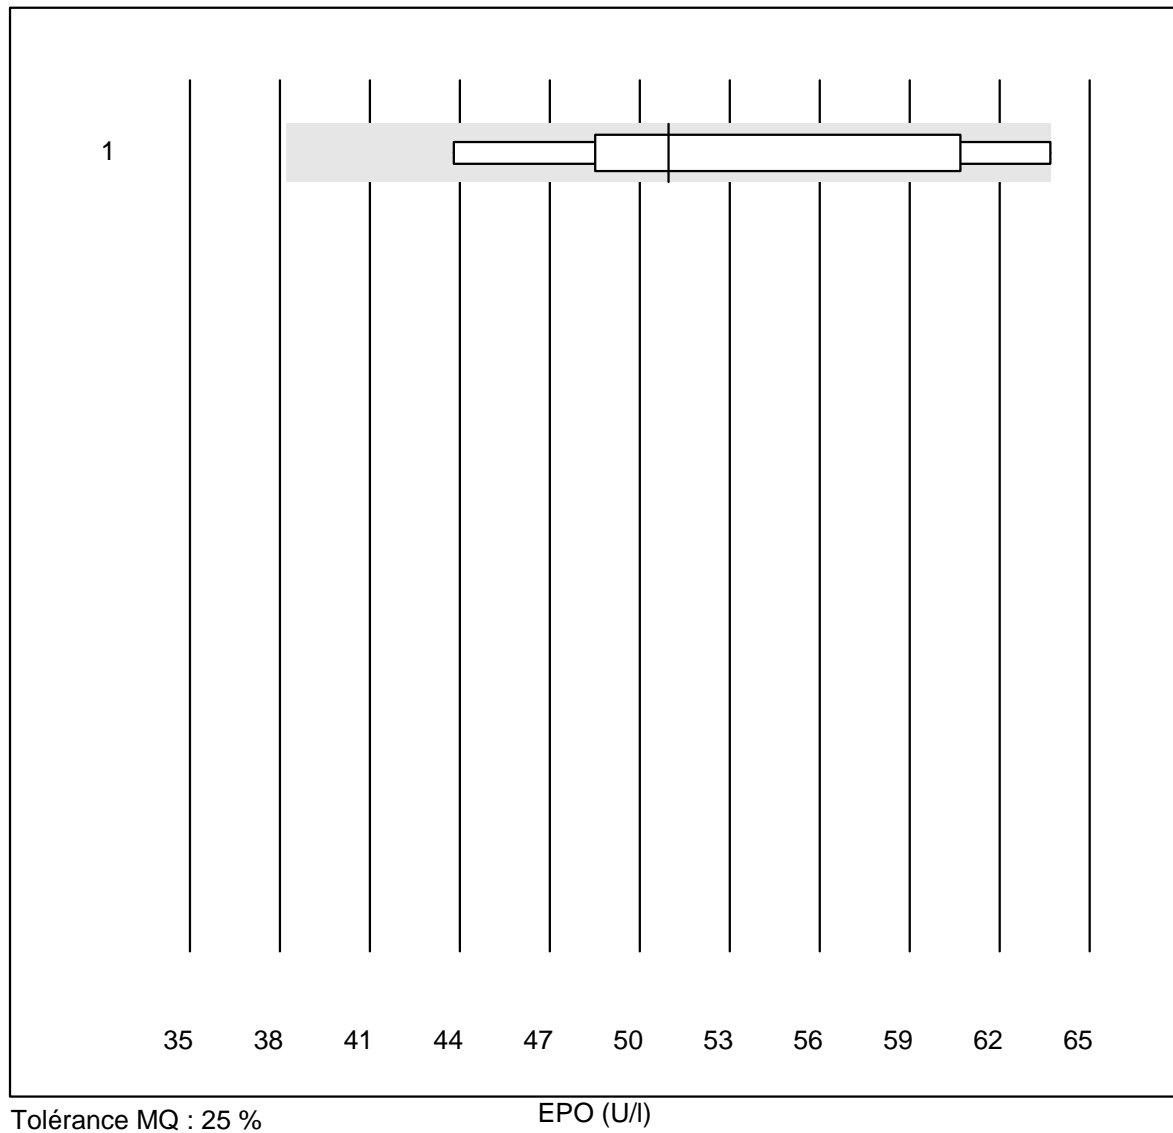


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	51.0	14.4	e*

Parathormone

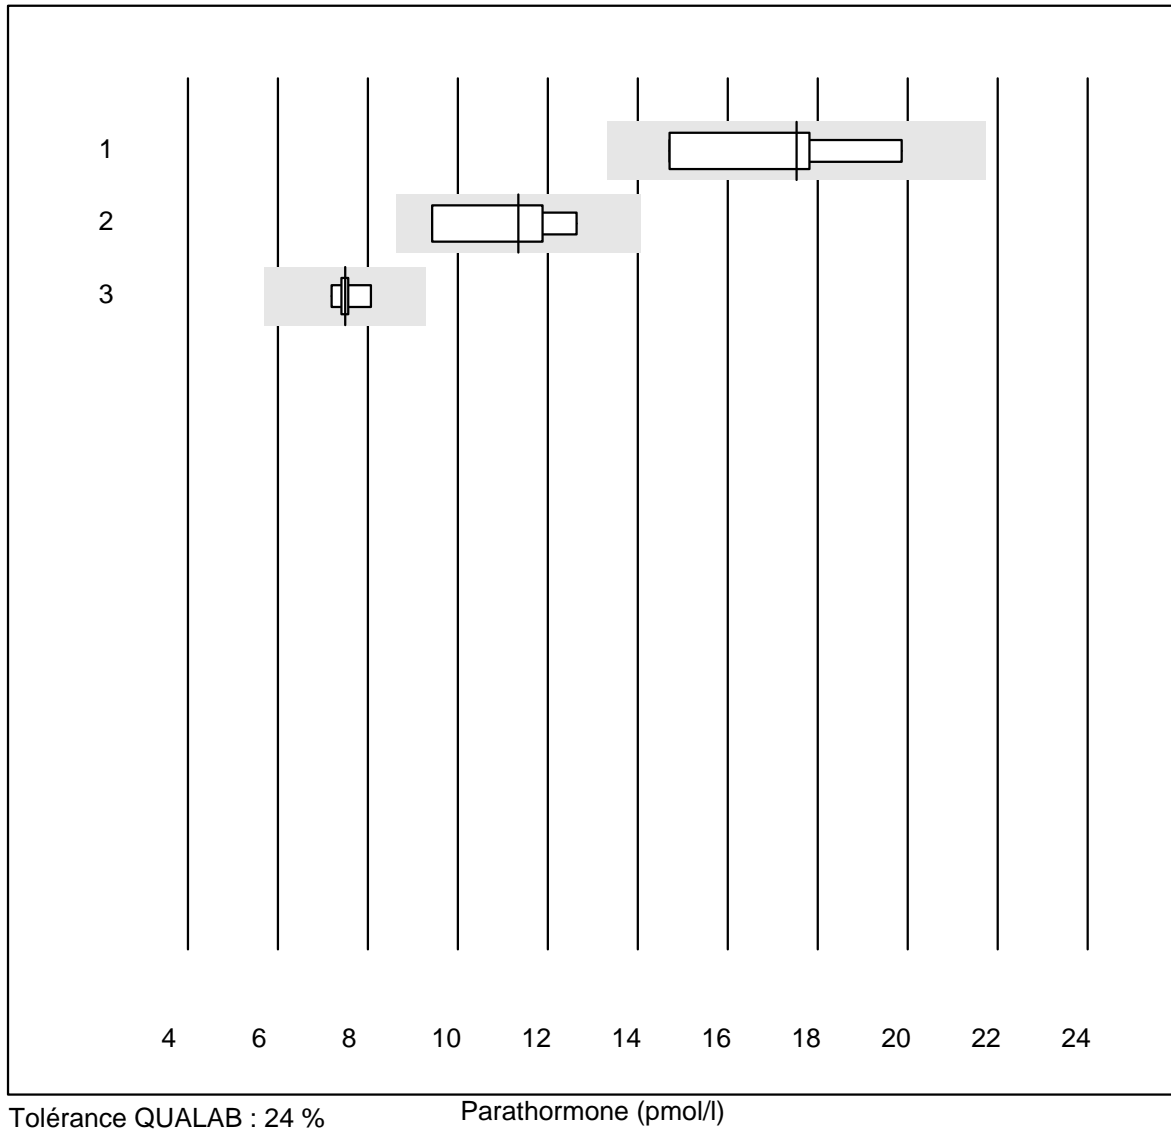

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Architect	4	100.0	0.0	0.0	17.5	12.2	e*
2	Cobas PTH STAT	4	100.0	0.0	0.0	11.3	12.5	e*
3	Cobas	5	100.0	0.0	0.0	7.5	4.3	e

Osmolalité

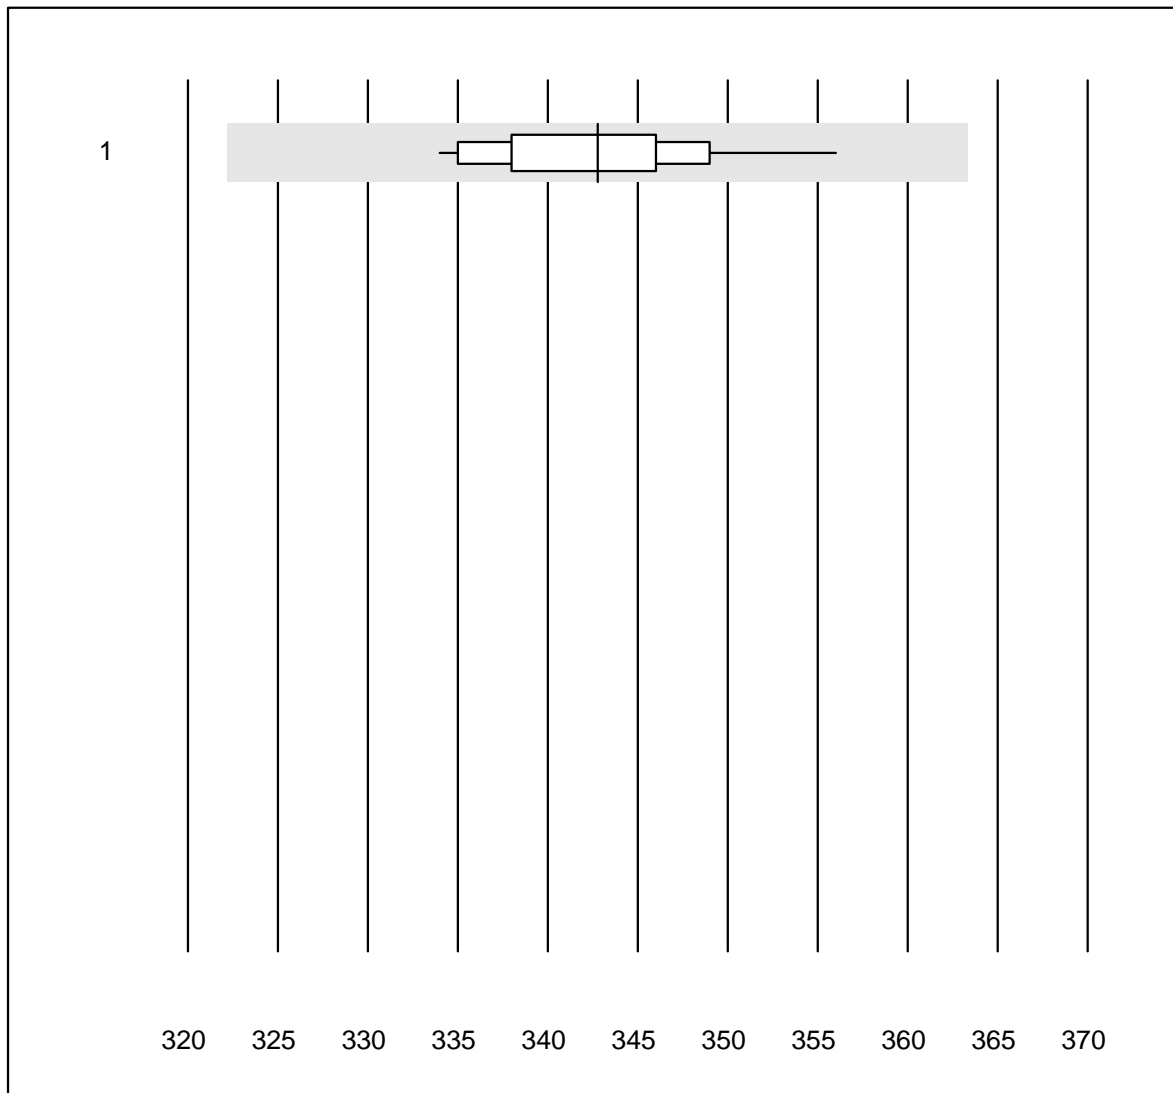


Tolérance QUALAB : 6 %

Osmolalité (mosm/kg)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cryoscopie	13	100.0	0.0	0.0	343	1.8	e

Kalium-K22

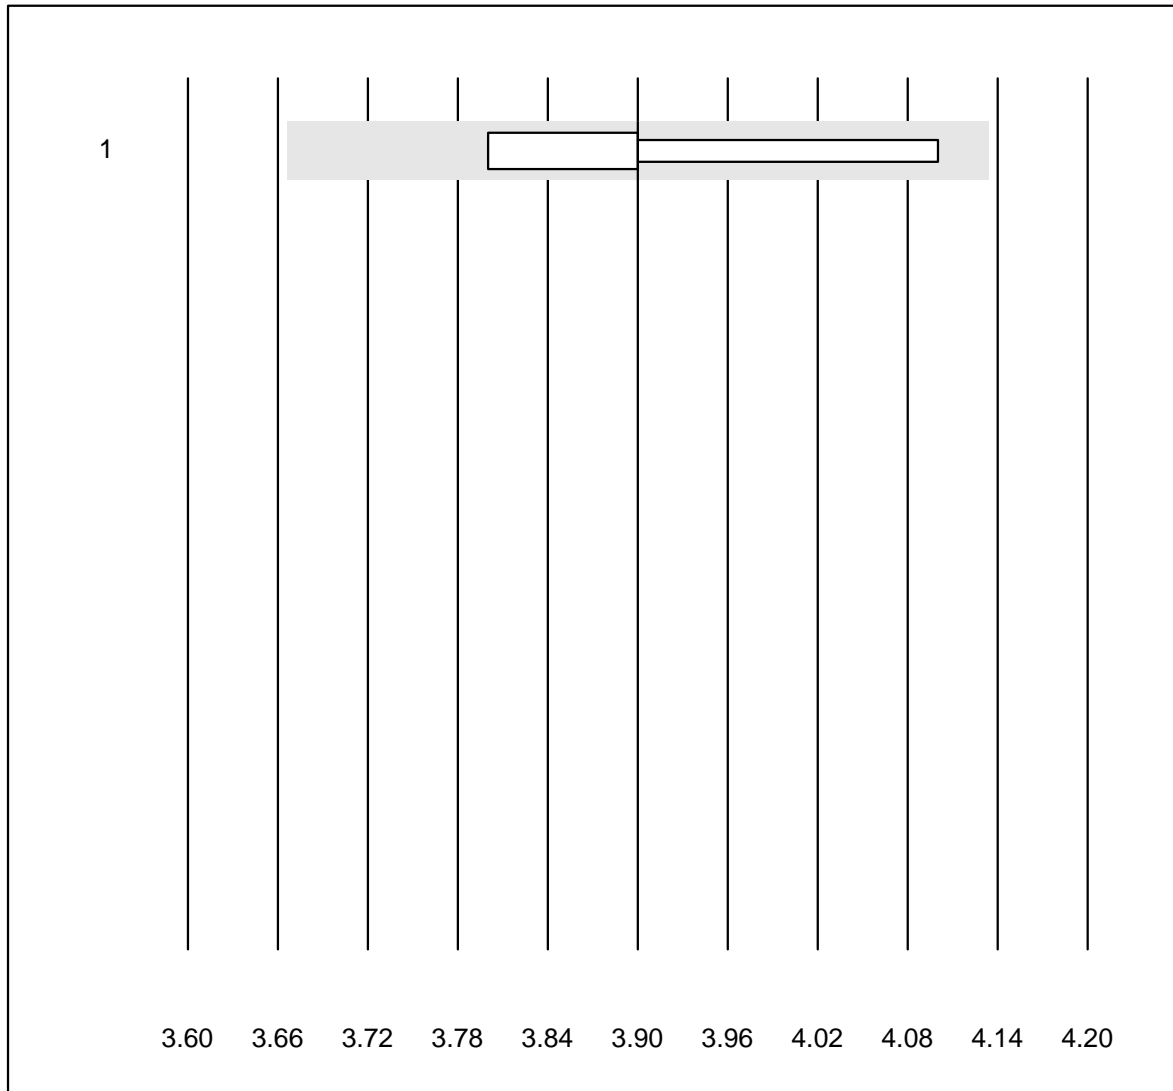


Tolérance QUALAB : 6 %

Kalium-K22 (mmol/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ISE	8	100.0	0.0	0.0	3.9	2.5	e*

Natrium-K22

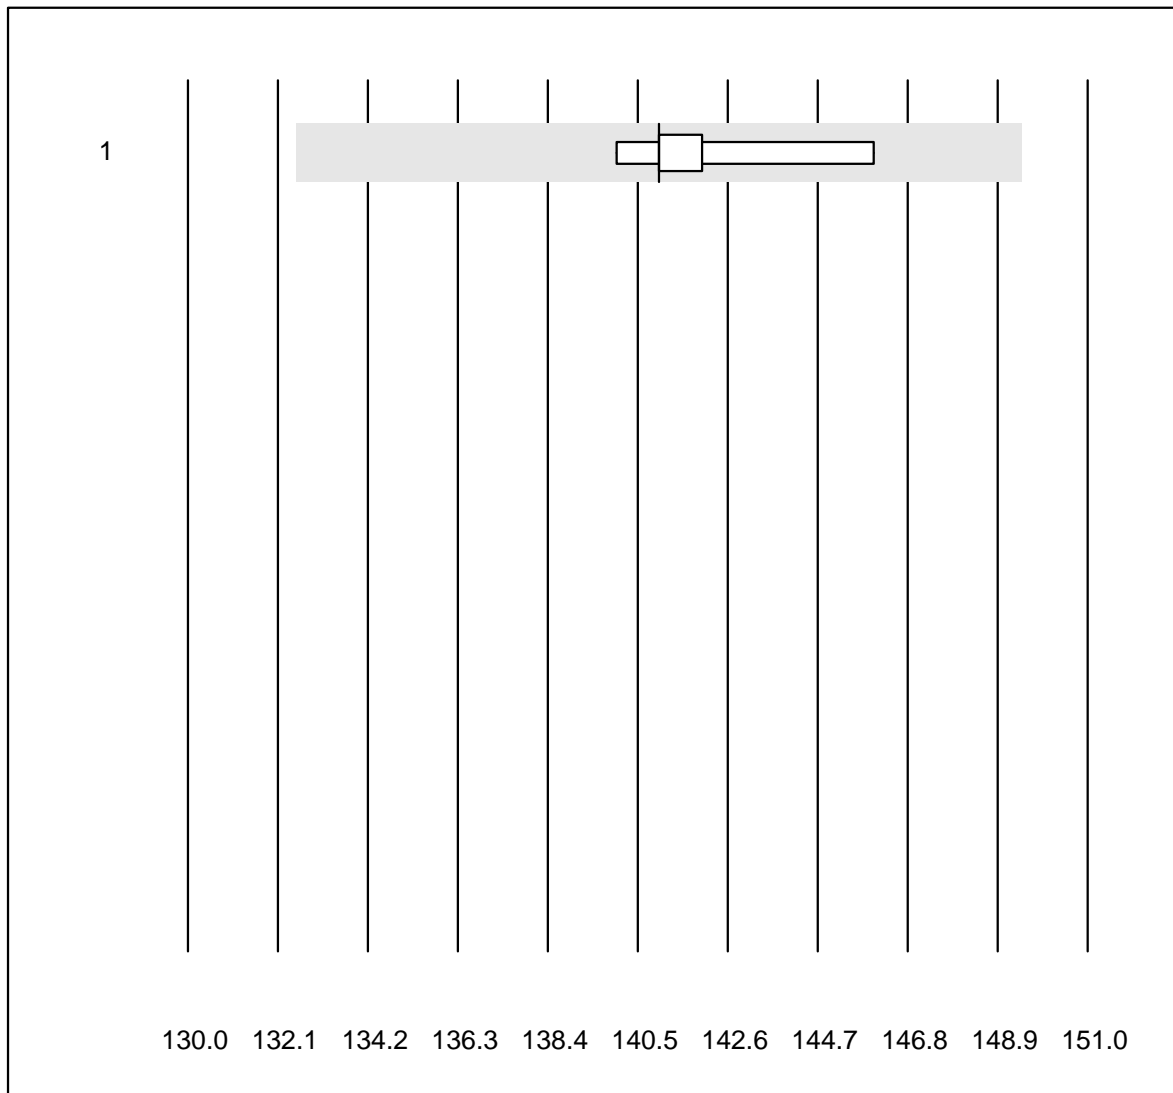


Tolérance QUALAB : 6 %

Natrium-K22 (mmol/l)

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 ISE	8	100.0	0.0	0.0	141	1.3	e

Glukose-K22

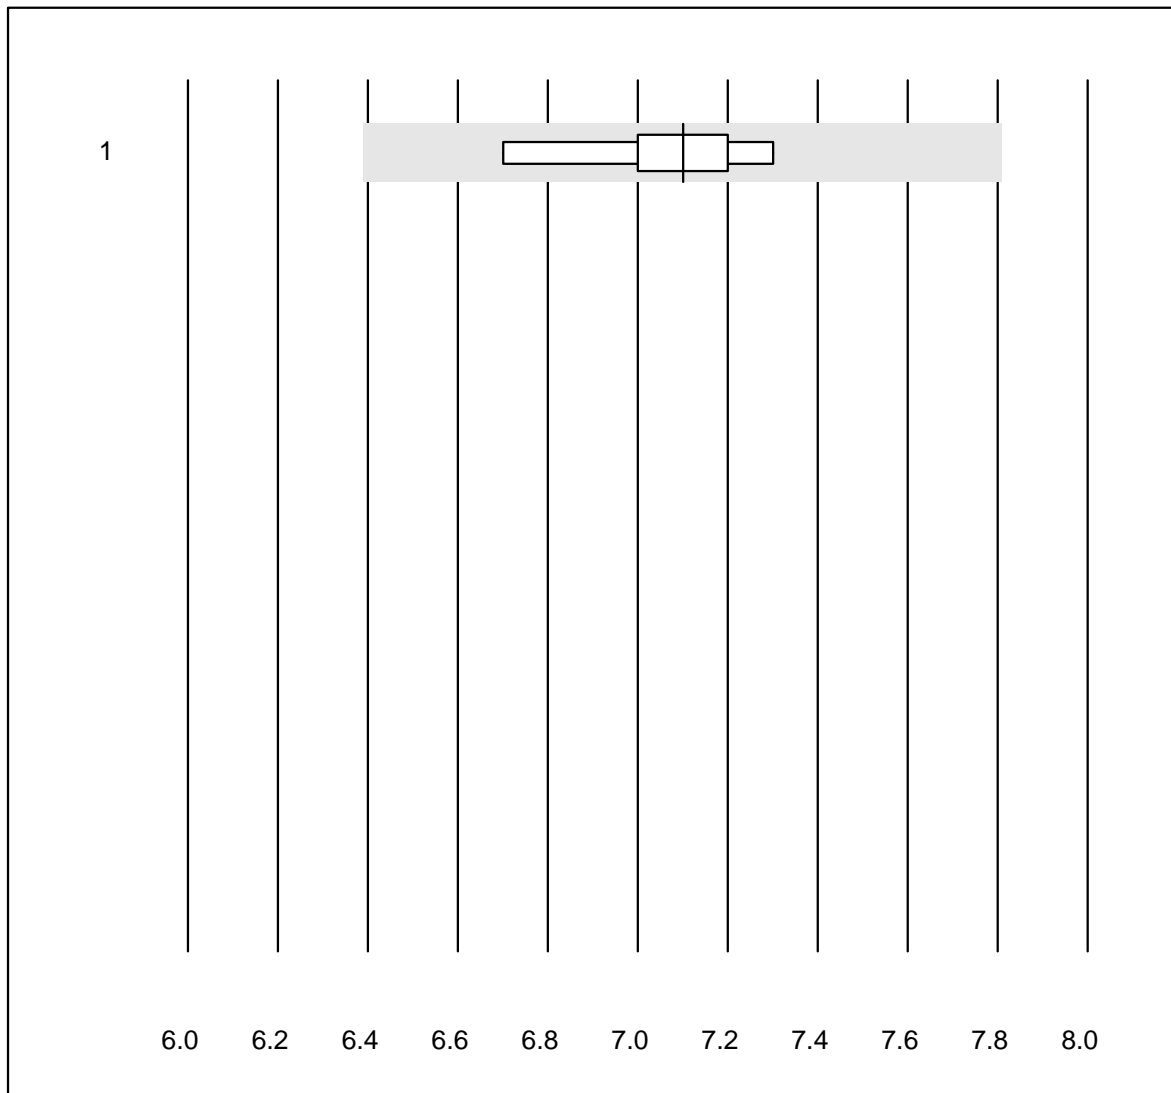


Tolérance QUALAB : 10 %

Glukose-K22 (mmol/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	8	100.0	0.0	0.0	7.1	2.6	e

Harnstoff-K22

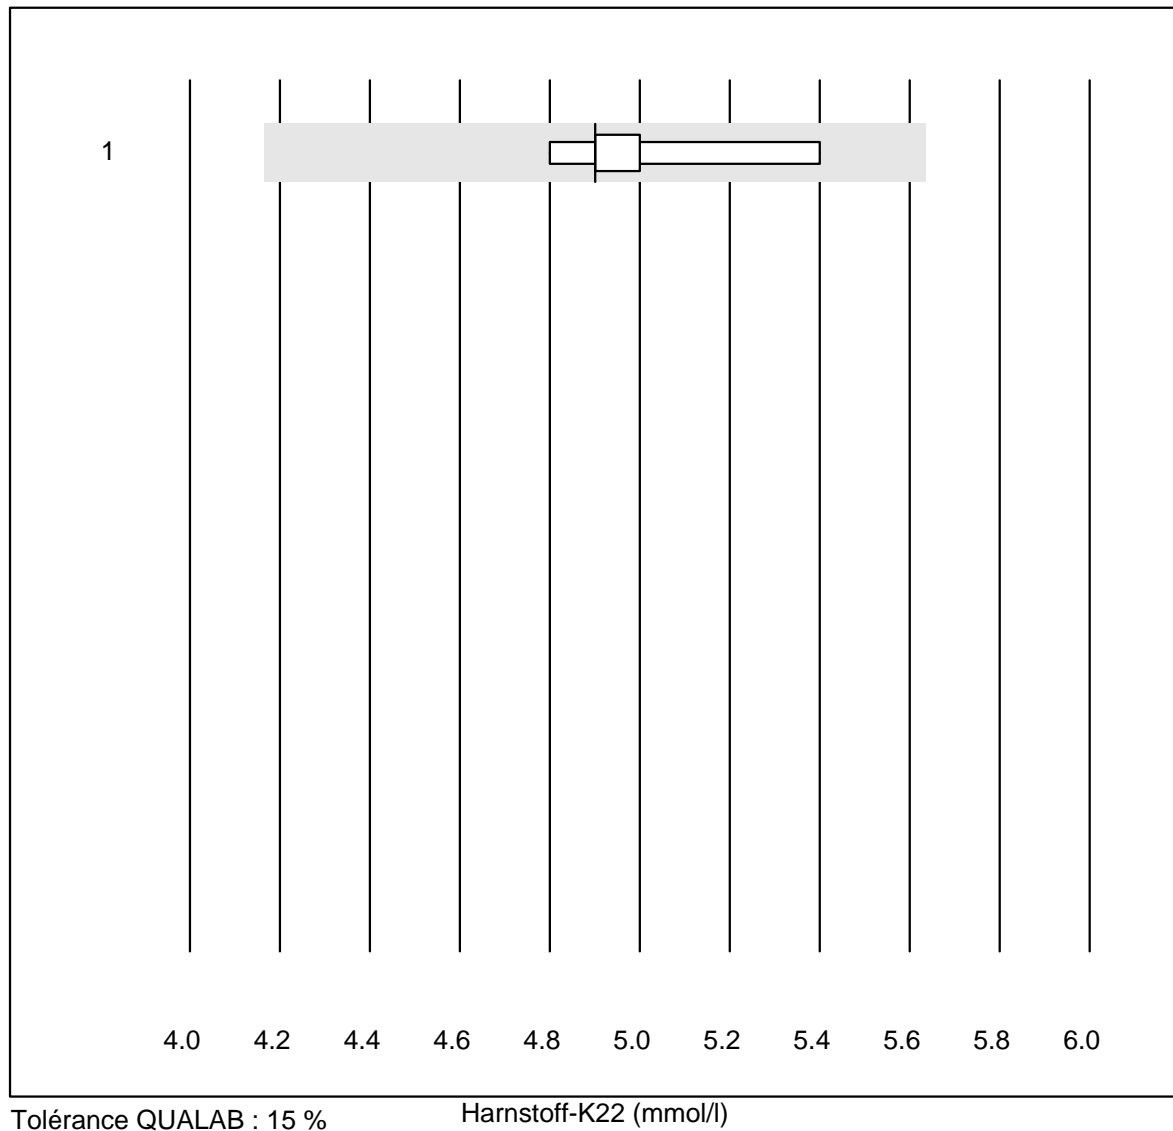


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Chimie humide	8	100.0	0.0	0.0	4.9	4.7	e

Osmotische Lücke

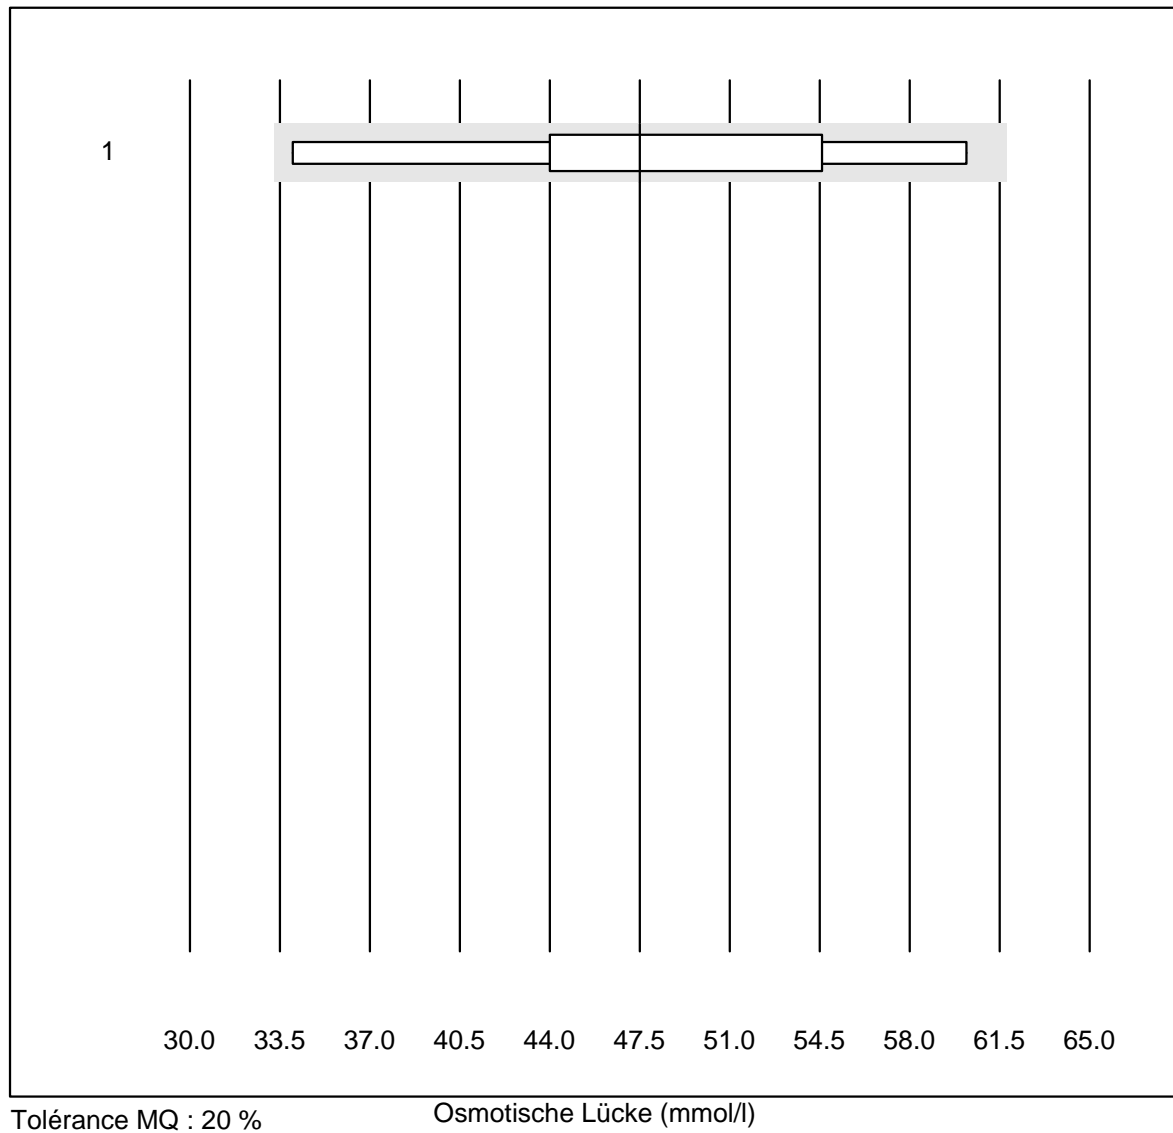


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Formel 1 (2Na+K+Glu+	7	100.0	0.0	0.0	47.5	17.4	a

Digoxin

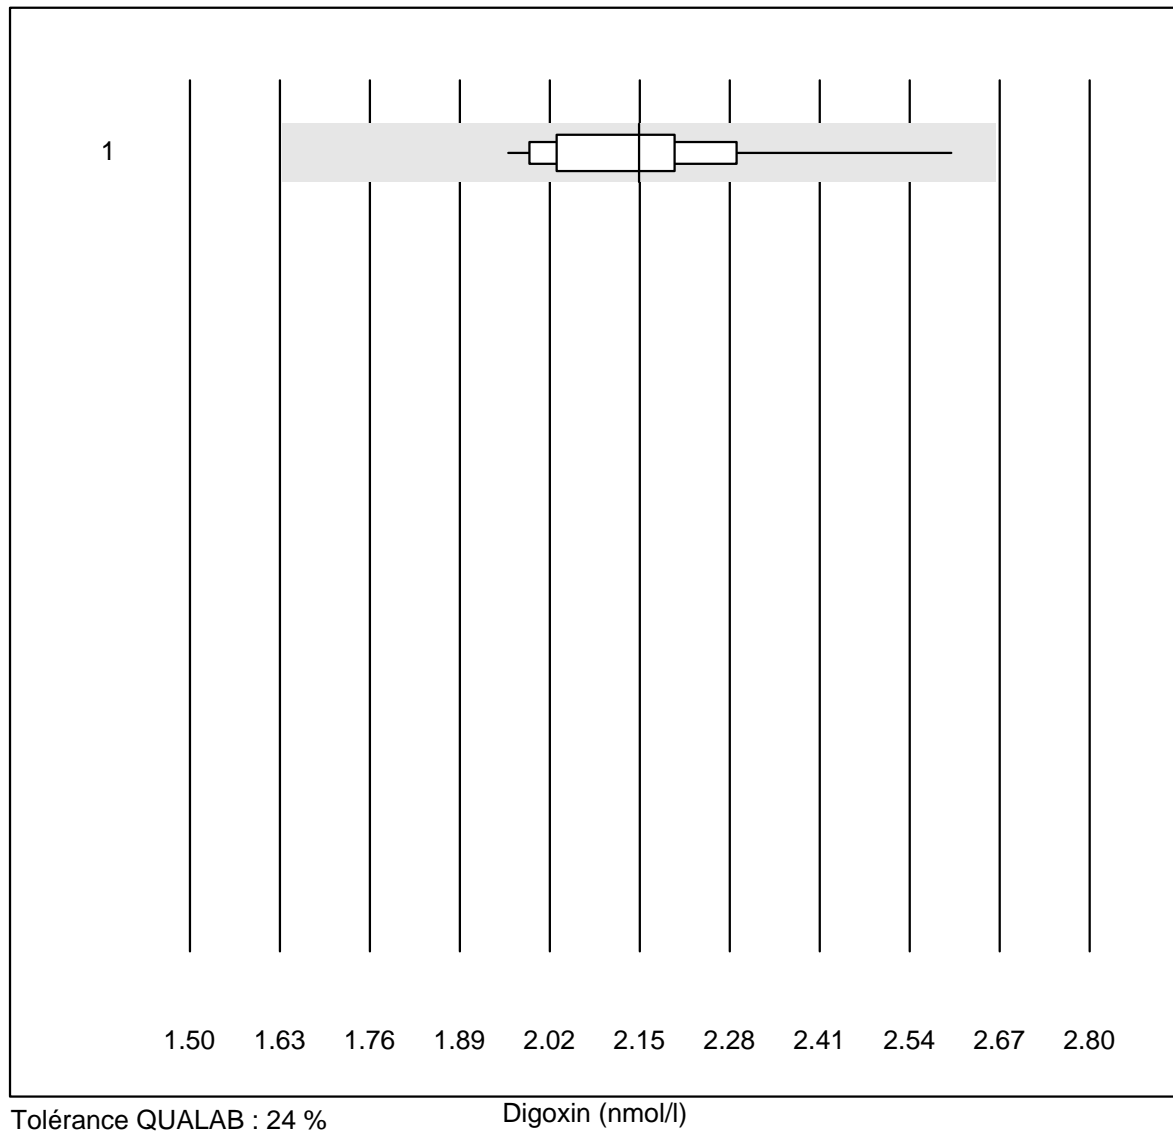


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Autres méthodes	13	100.0	0.0	0.0	2.15	8.0	e

Phénytoin

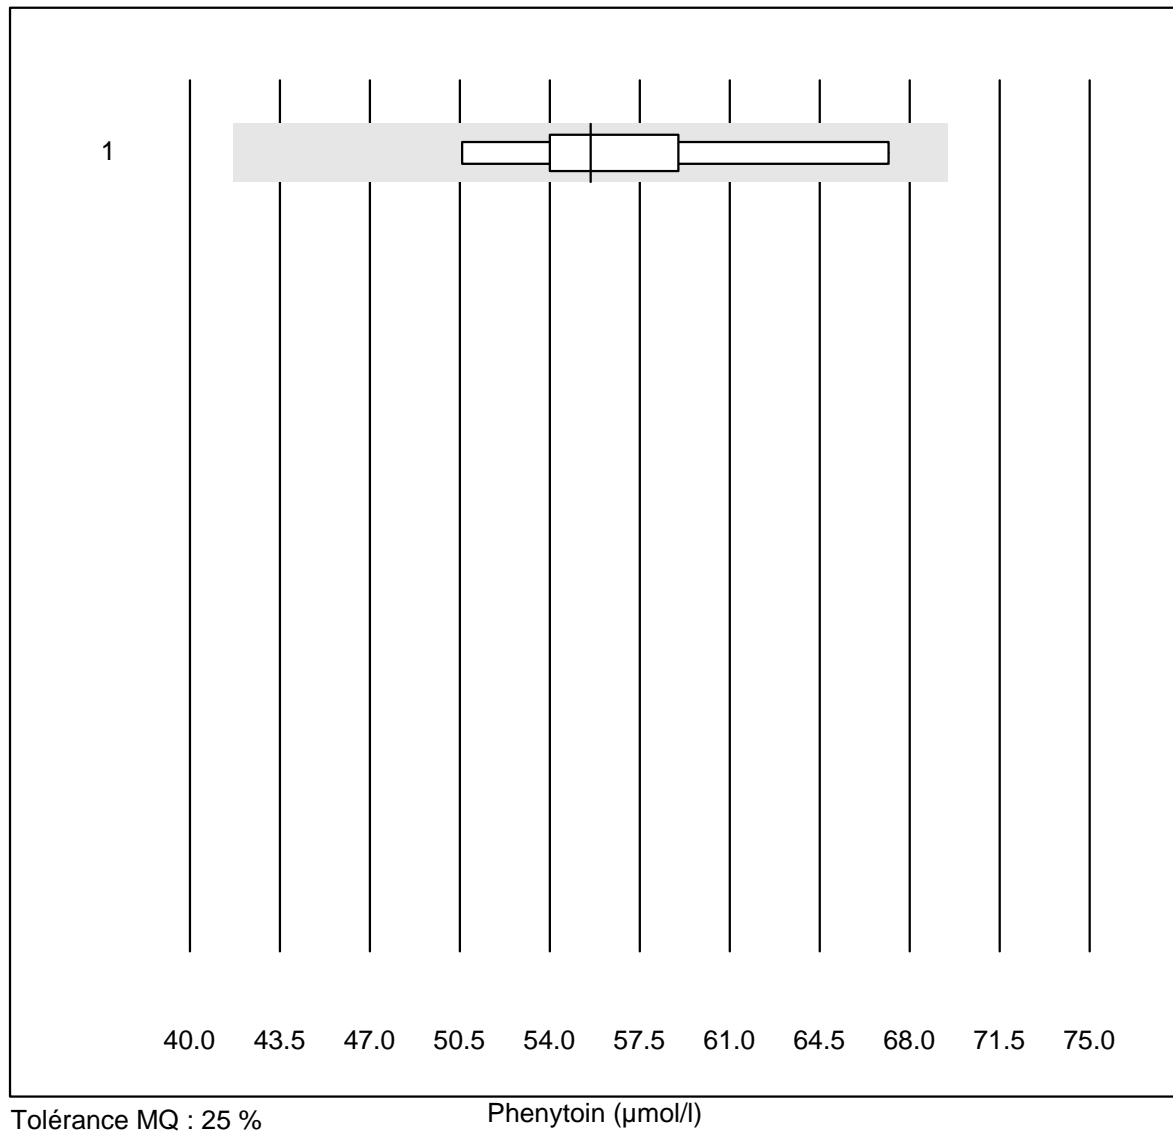


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	56	11.0	e*

Phenobarbital

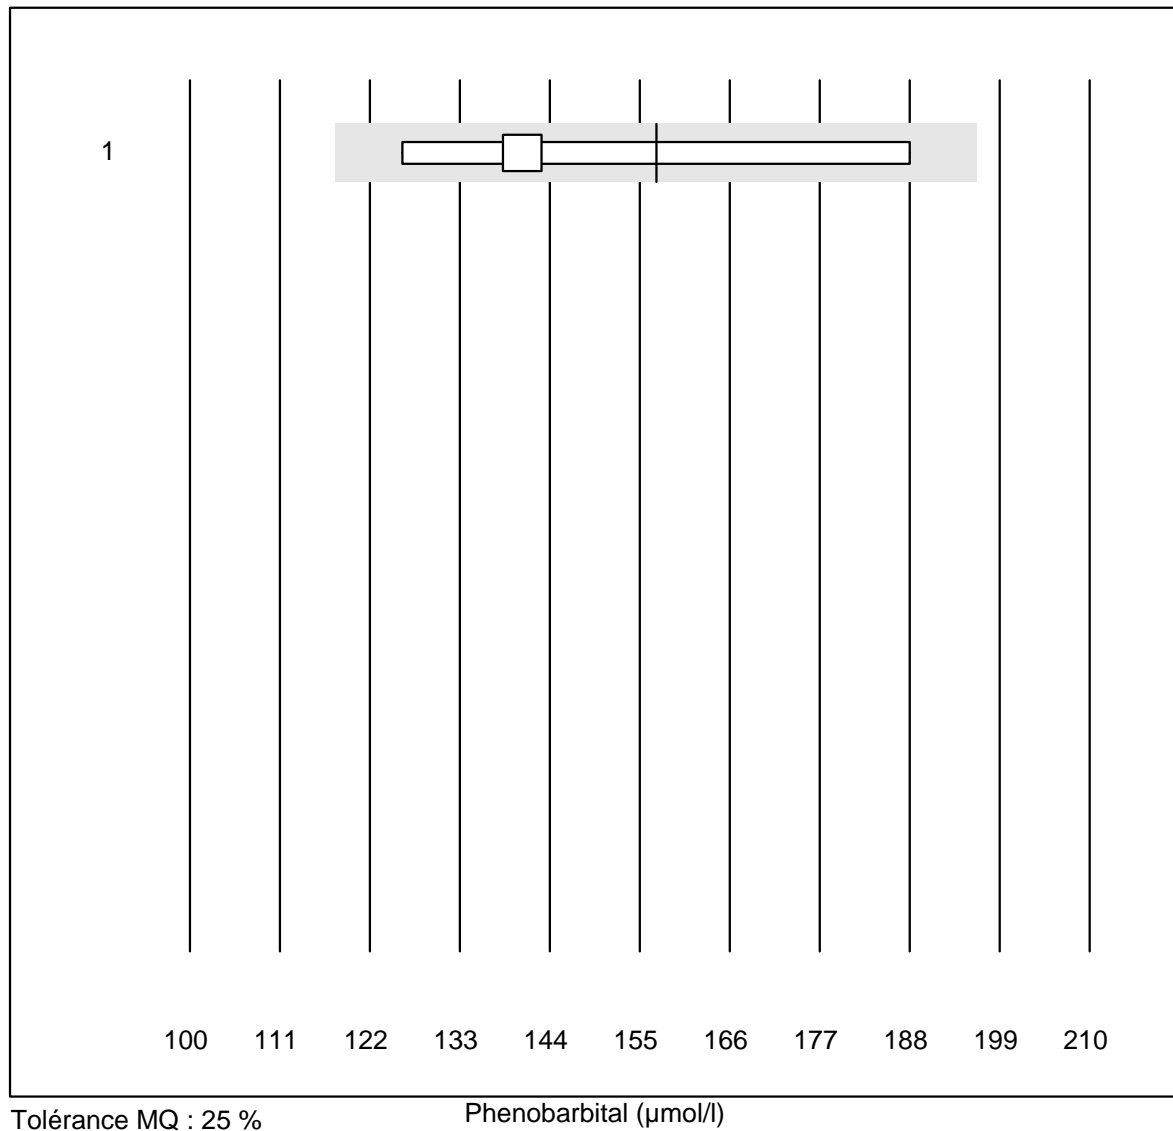


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	157	16.2 a

Vancomycin

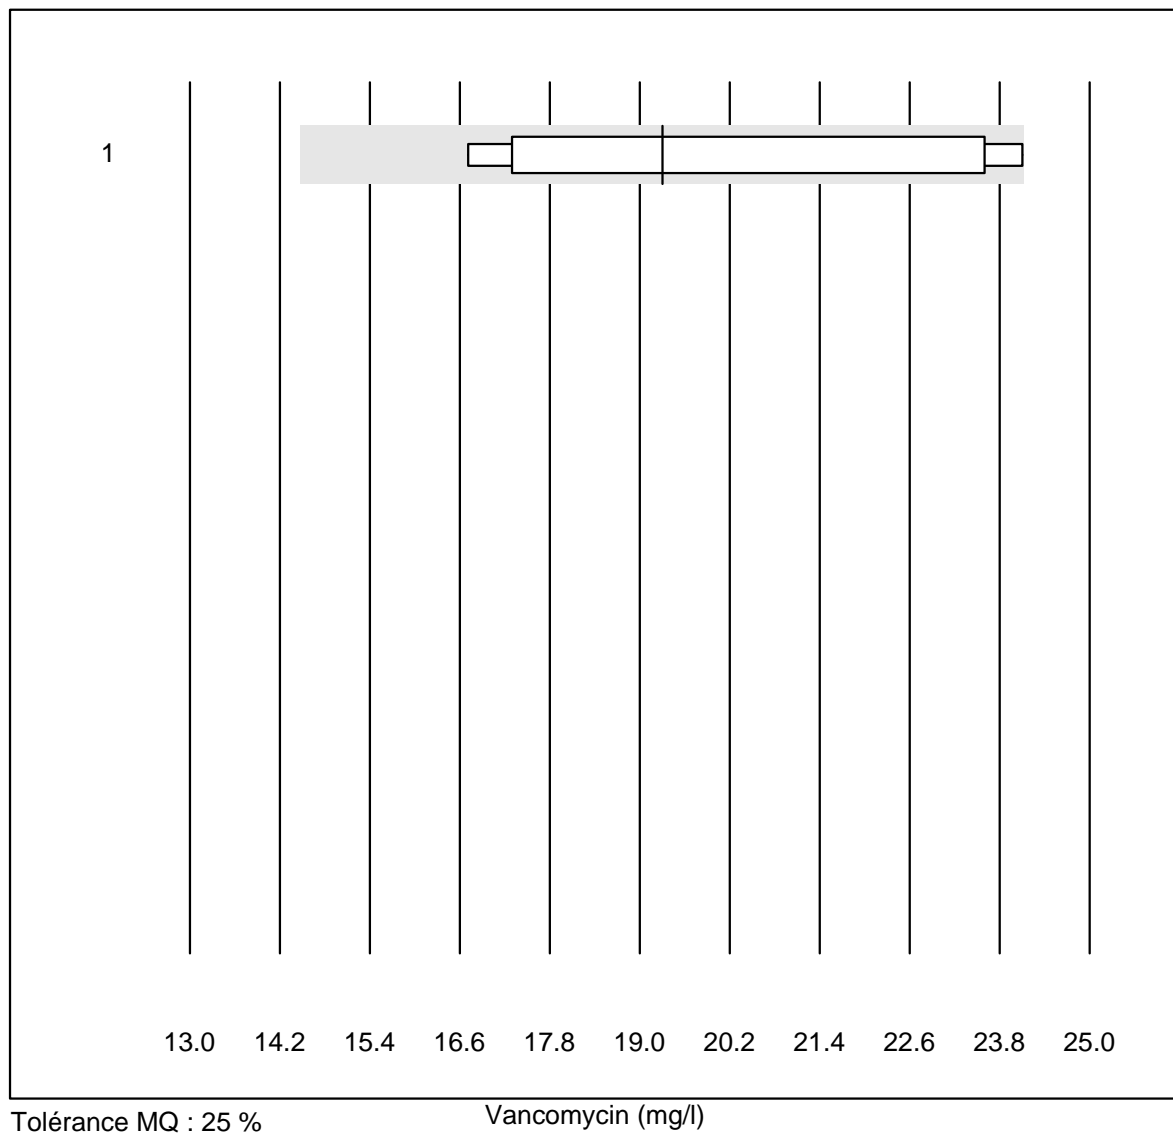


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	19	17.2	e*

Valproat

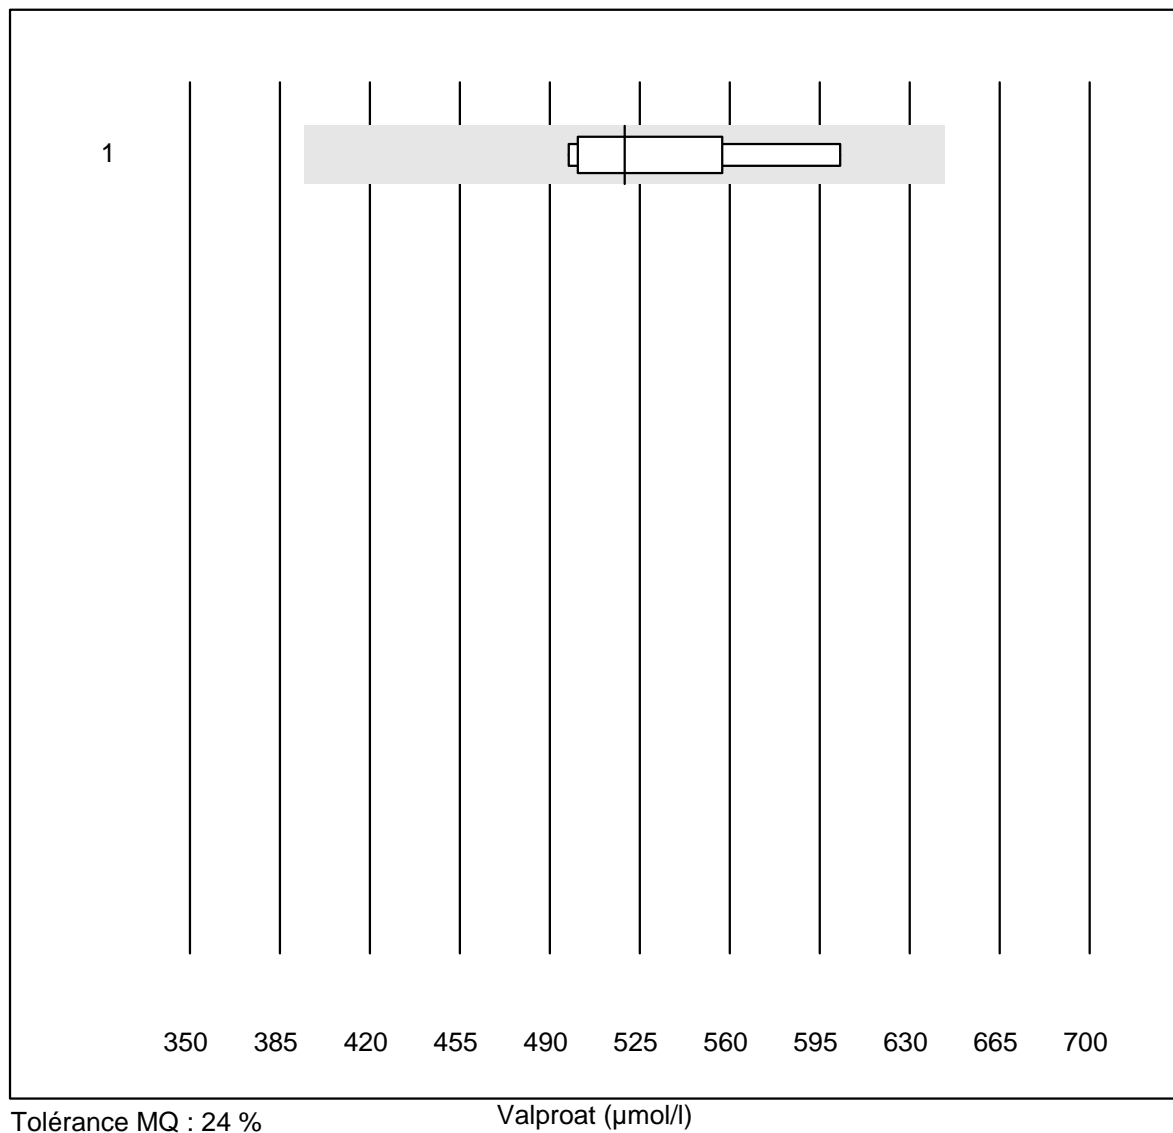


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	519.0	6.9	e

Cystatin C

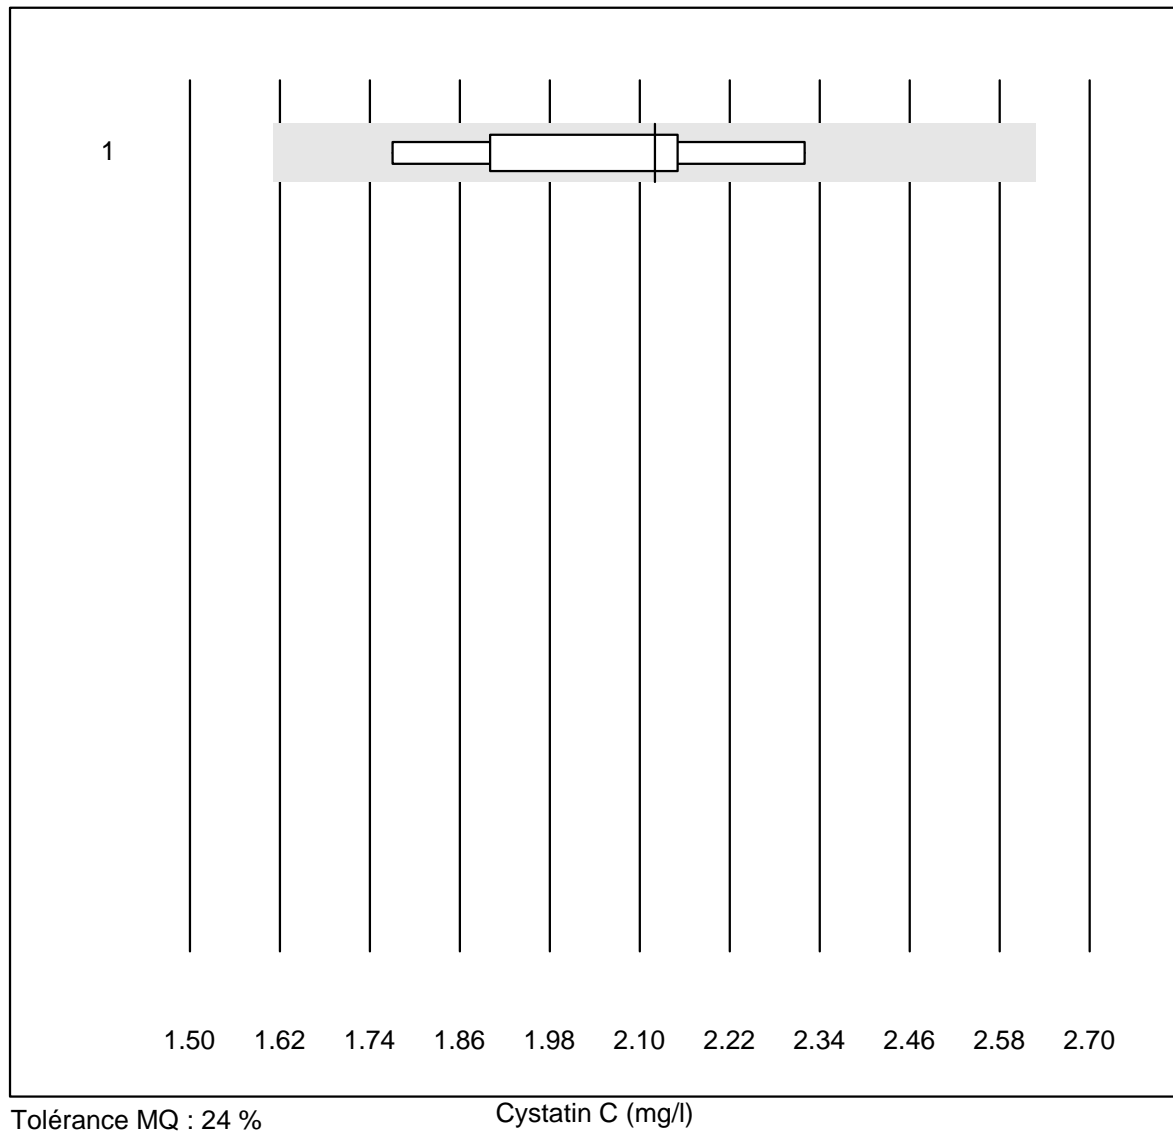

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	9	100.0	0.0	0.0	2.1	8.9	e*


Éthanol

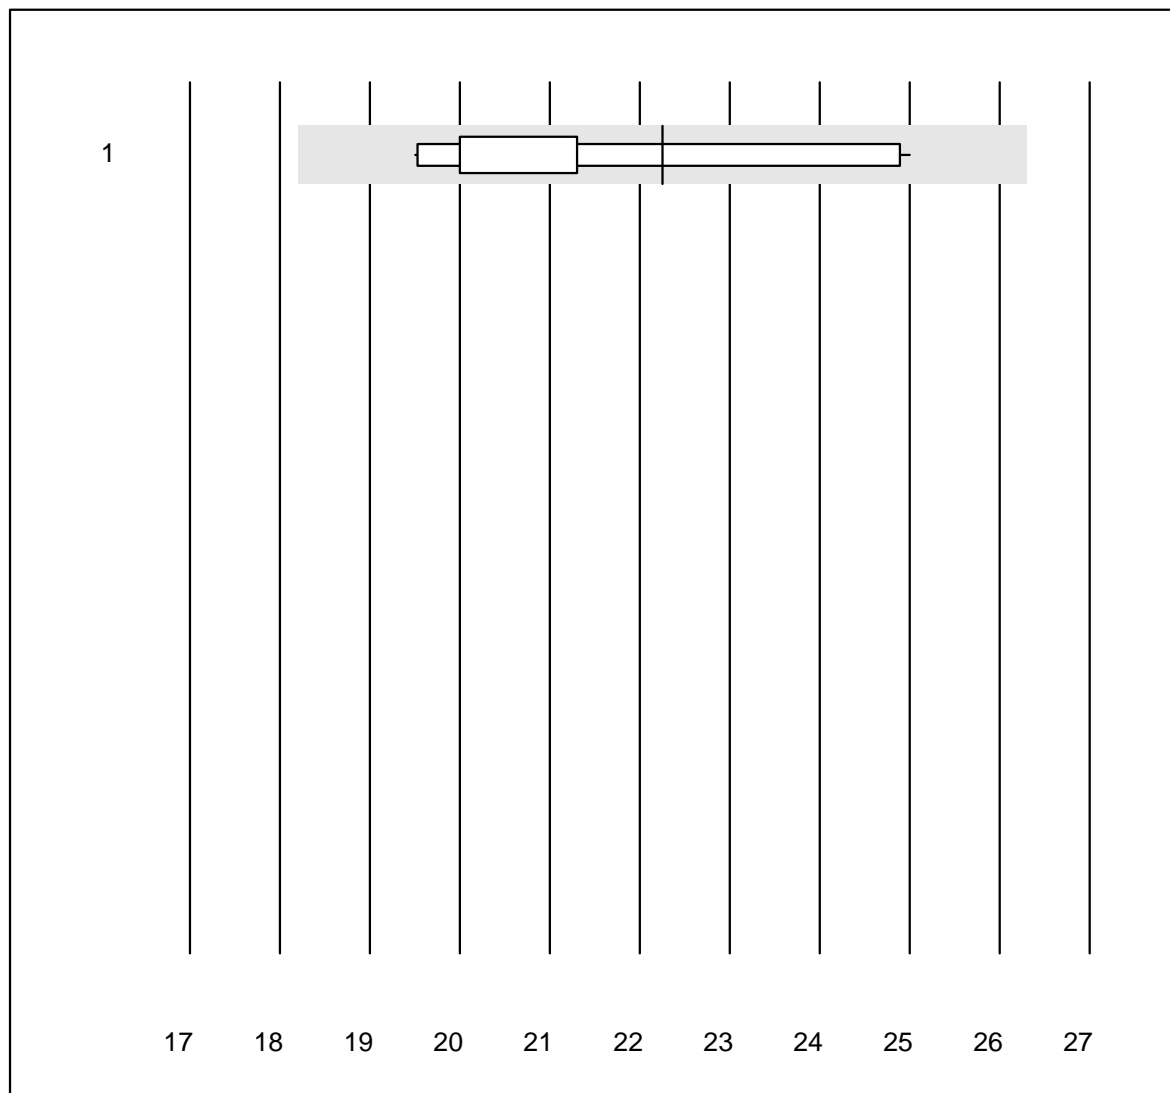

Tolérance QUALAB : 18 % Éthanol (mmol/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 toutes les méthodes	17	94.1	0.0	5.9	22.3	8.8	a

Calprotectin

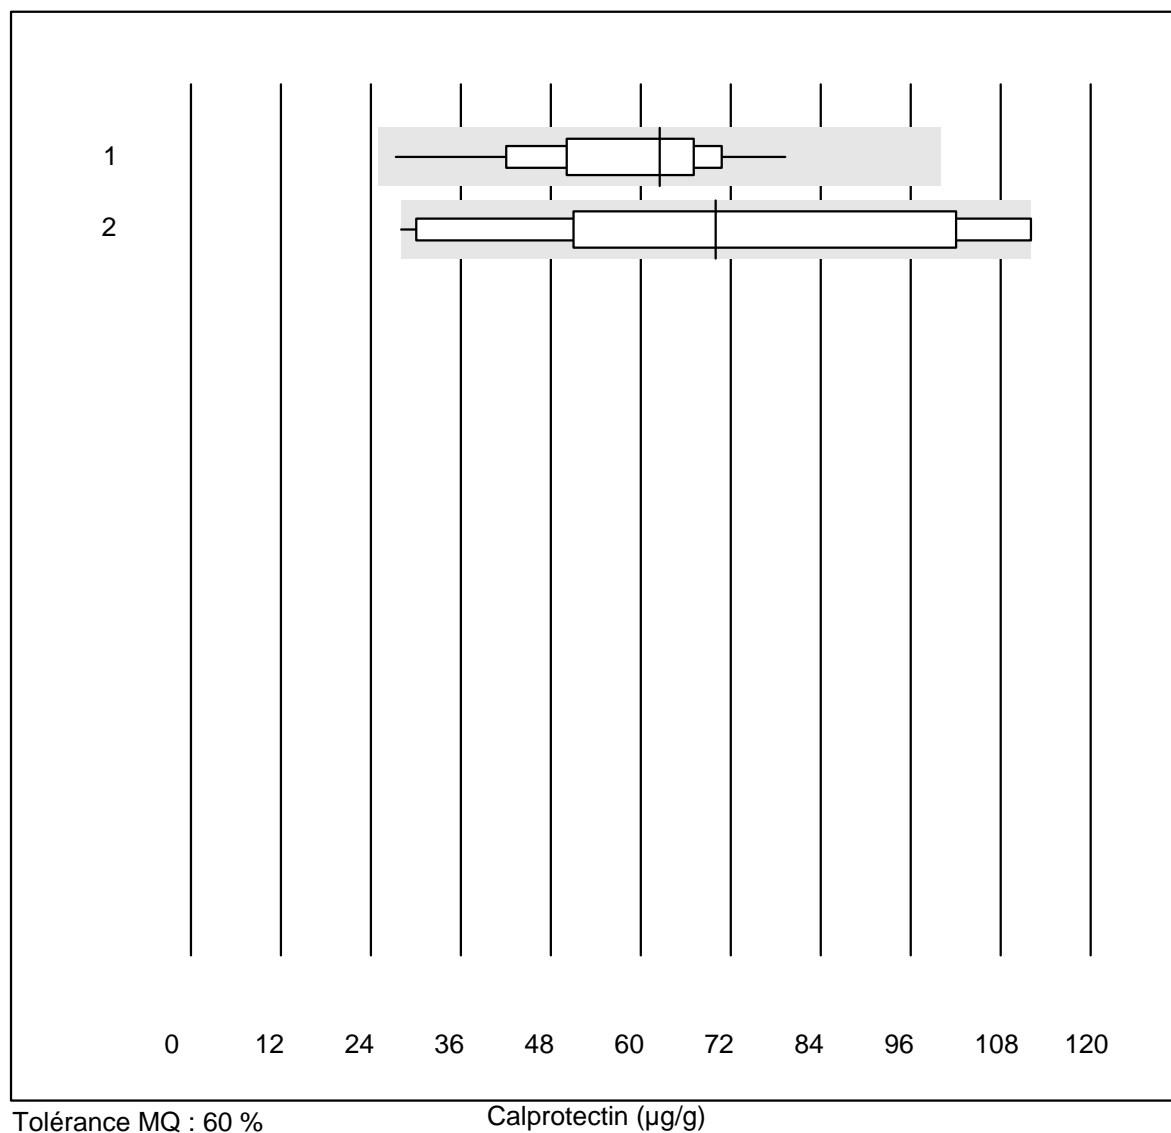

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Liaison	19	100.0	0.0	0.0	63	21.0	a
2 Bühlmann	20	75.0	15.0	10.0	70	39.3	a

Cholestérol Af/b101

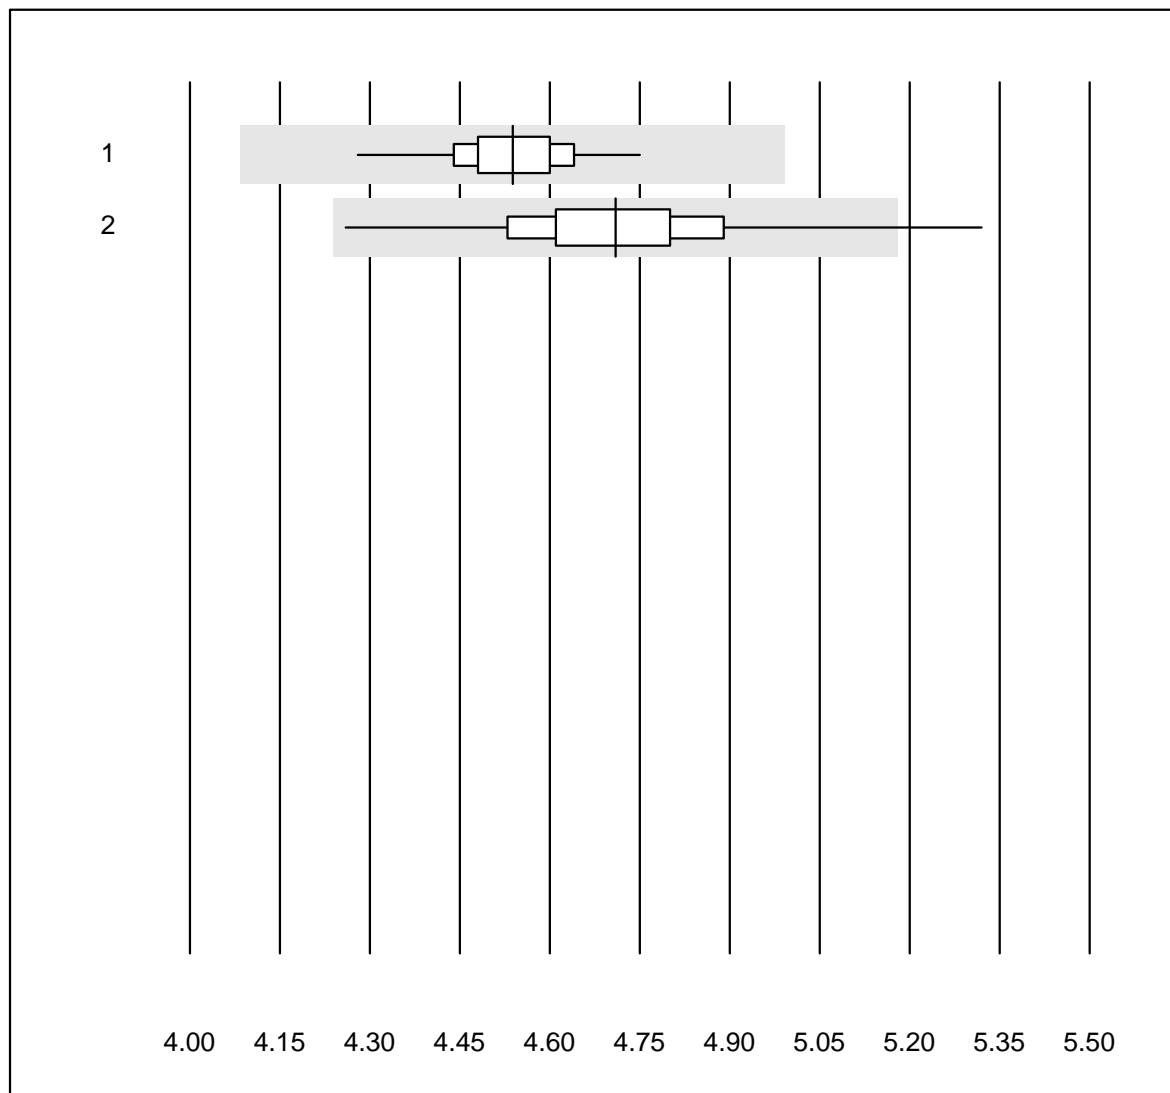


Tolérance QUALAB : 10 %

Cholestérol Af/b101 (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas b101	60	95.0	0.0	5.0	4.54	2.0	e
2	Afinion	371	99.2	0.8	0.0	4.71	3.2	e


Cholestérol HDL Af/b101

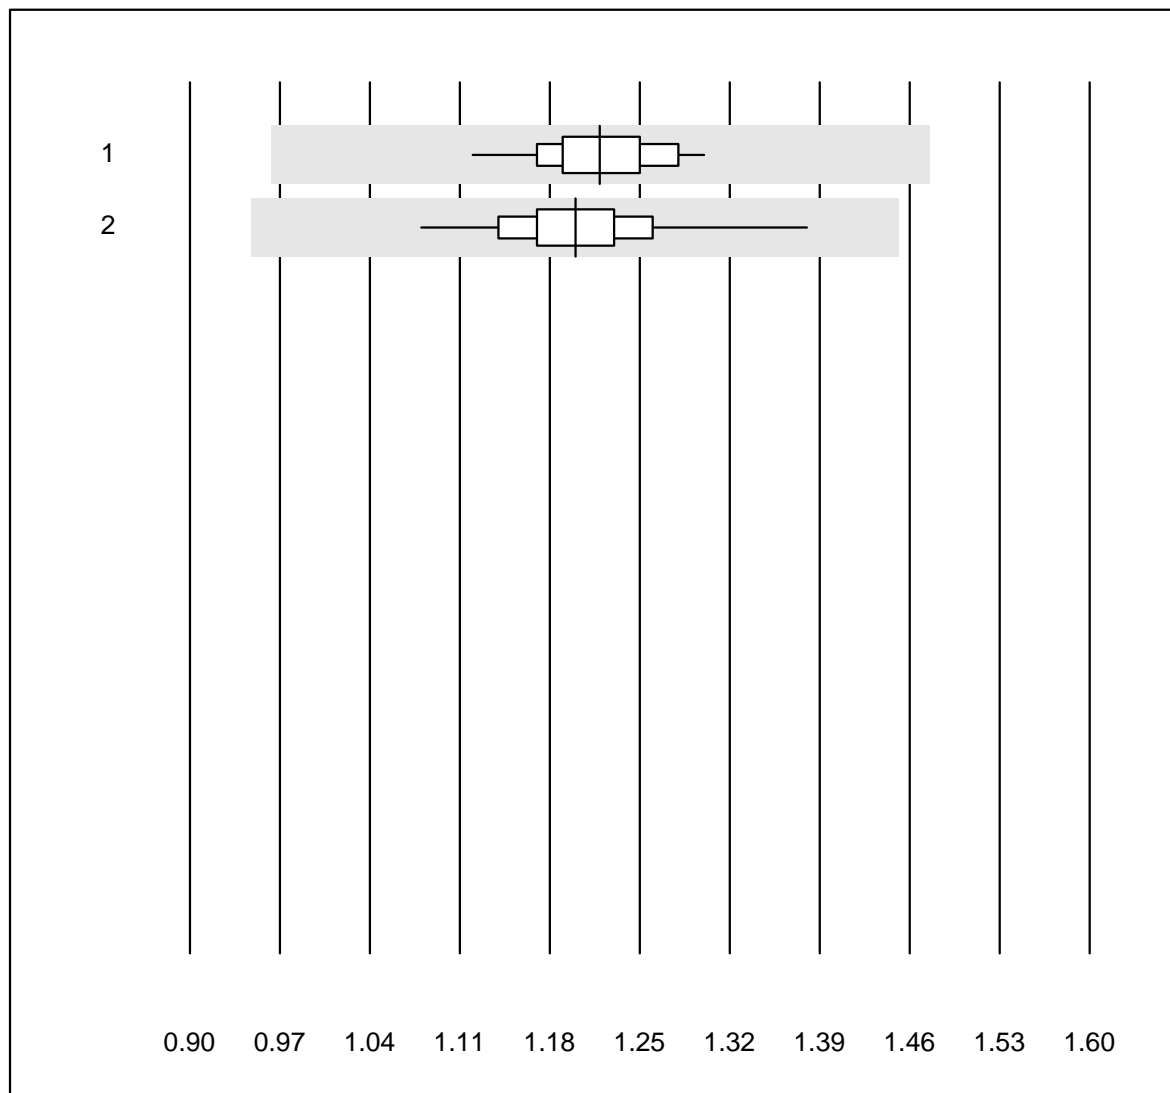

Tolérance QUALAB : 21 % Cholestérol HDL Af/b101 (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas b101	60	91.7	0.0	8.3	1.22	3.4	e
2	Afinion	367	95.1	0.0	4.9	1.20	4.0	e

Triglycerides Af/b101

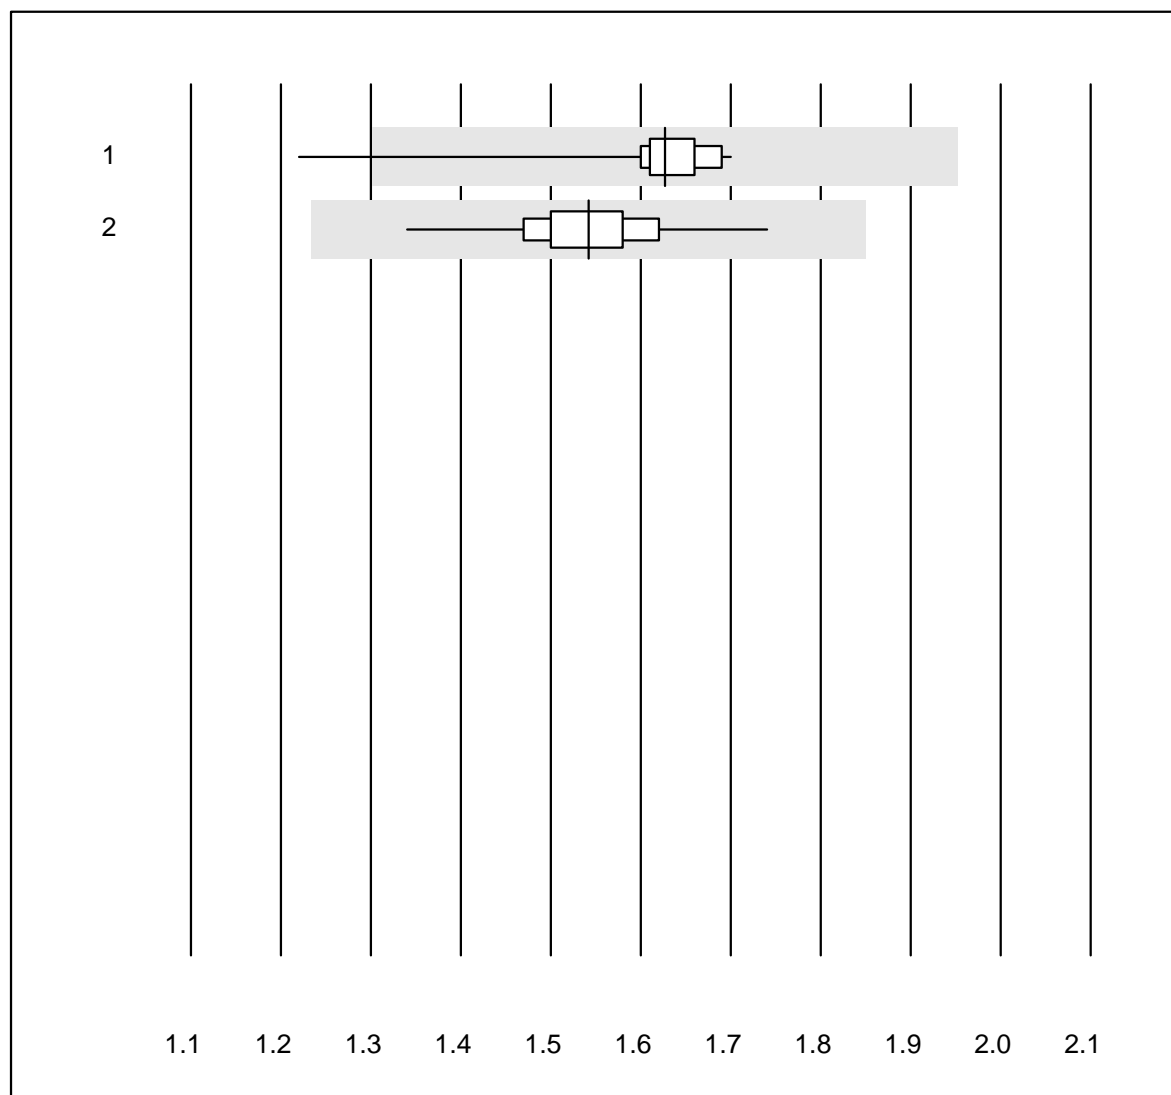


Tolérance QUALAB : 20 %

Triglycerides Af/b101 (mmol/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas b101	58	94.9	1.7	3.4	1.63	4.3	e
2 Afinion	371	100.0	0.0	0.0	1.54	3.8	e

Troponine I S

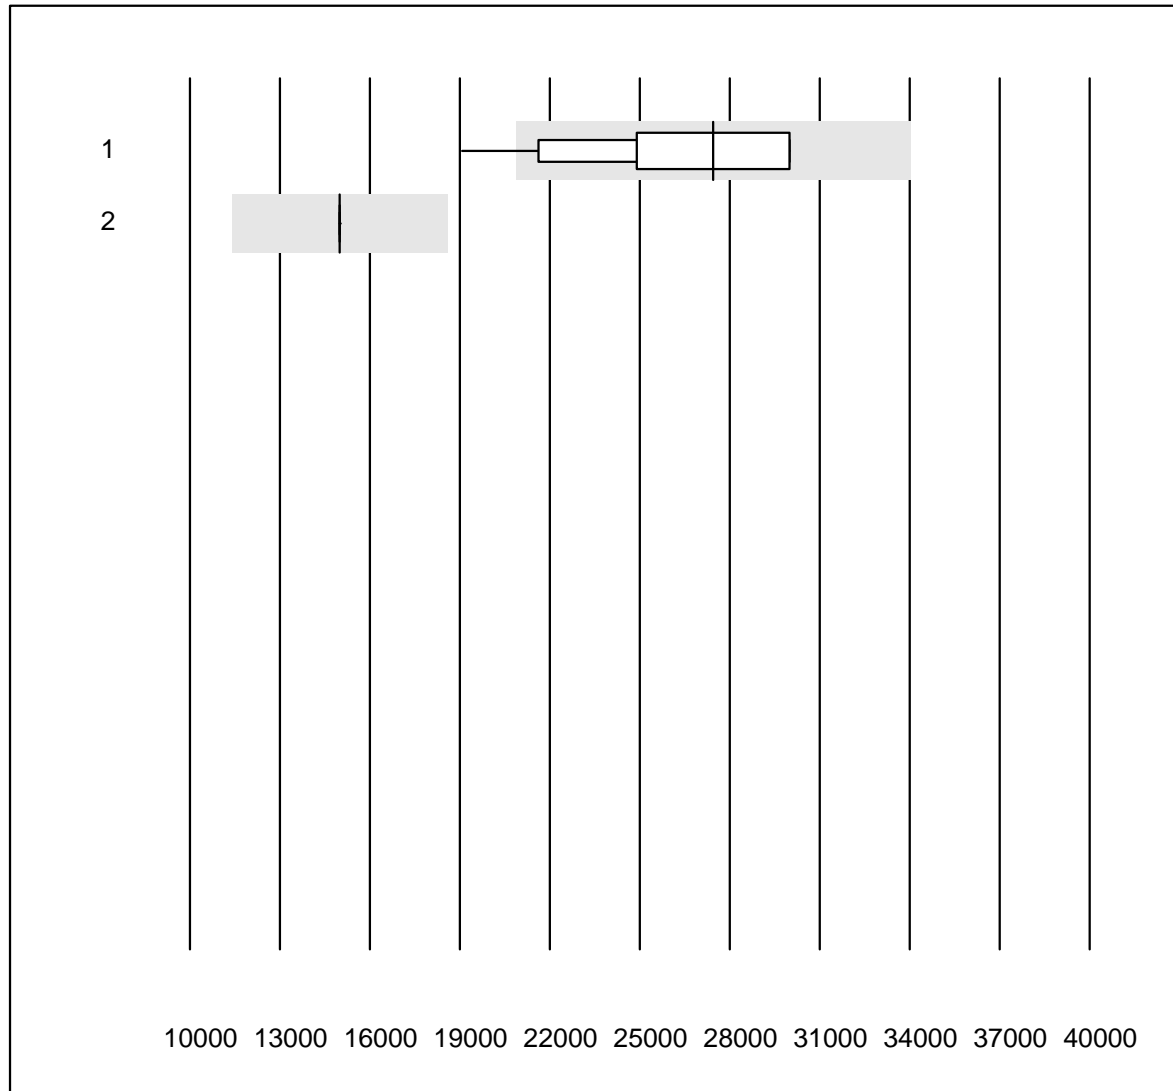


Tolérance QUALAB : 24 %

Troponine I S (ng/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Samsung LABGEO IB10	41	90.2	4.9	4.9	27447.18	12.5	e
2	AFIAS	43	97.7	0.0	2.3	15000.00	0.0	e

D-Dimères qn S

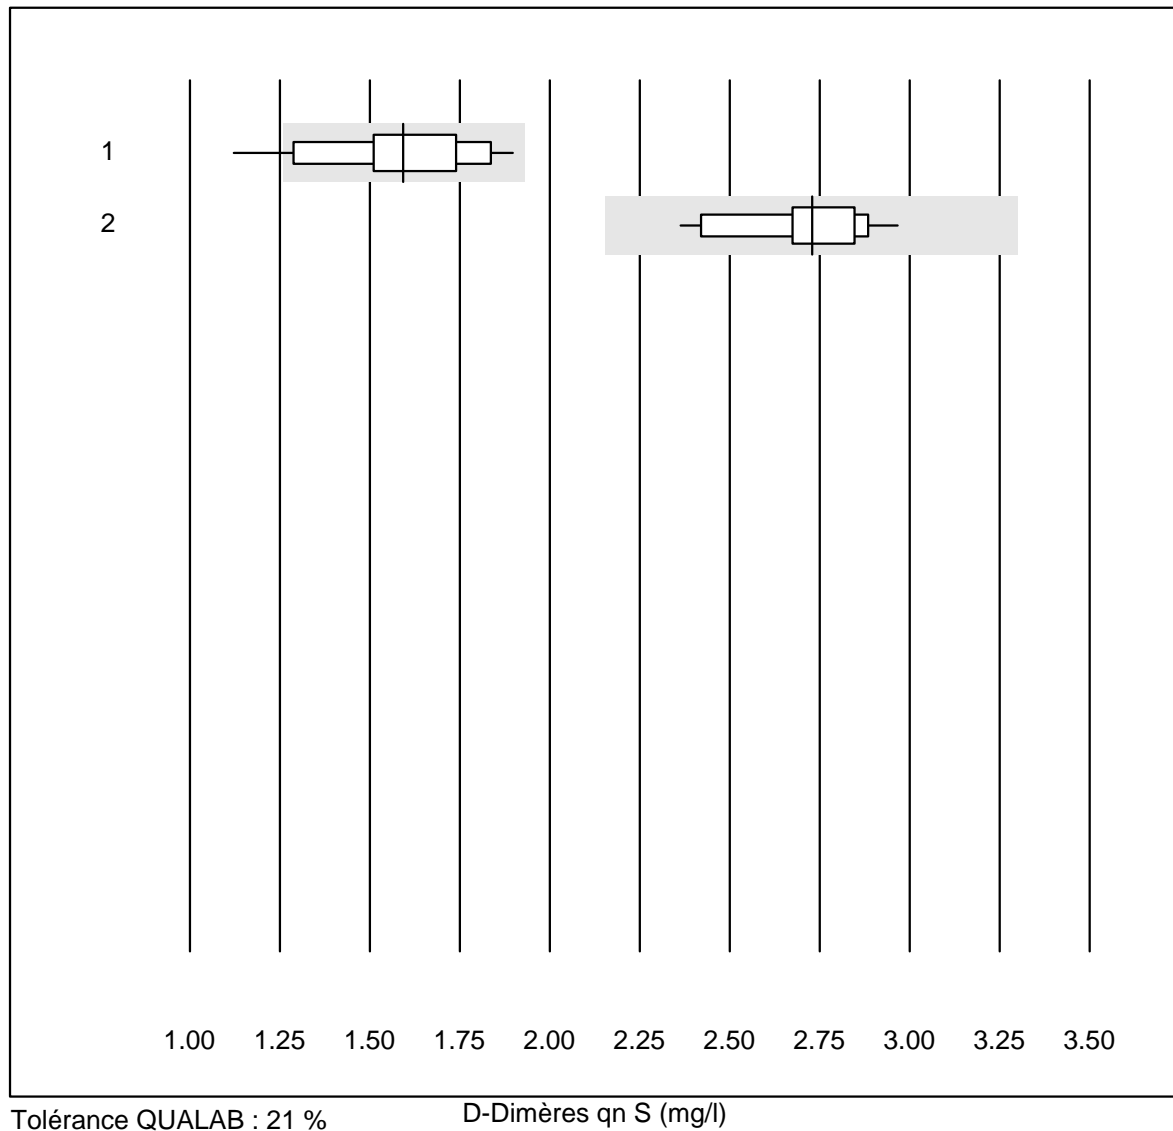


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Samsung LABGEO IB10	53	92.4	5.7	1.9	1.59	12.3	e
2	AFIAS	45	91.1	0.0	8.9	2.73	6.0	e

NT-proBNP S

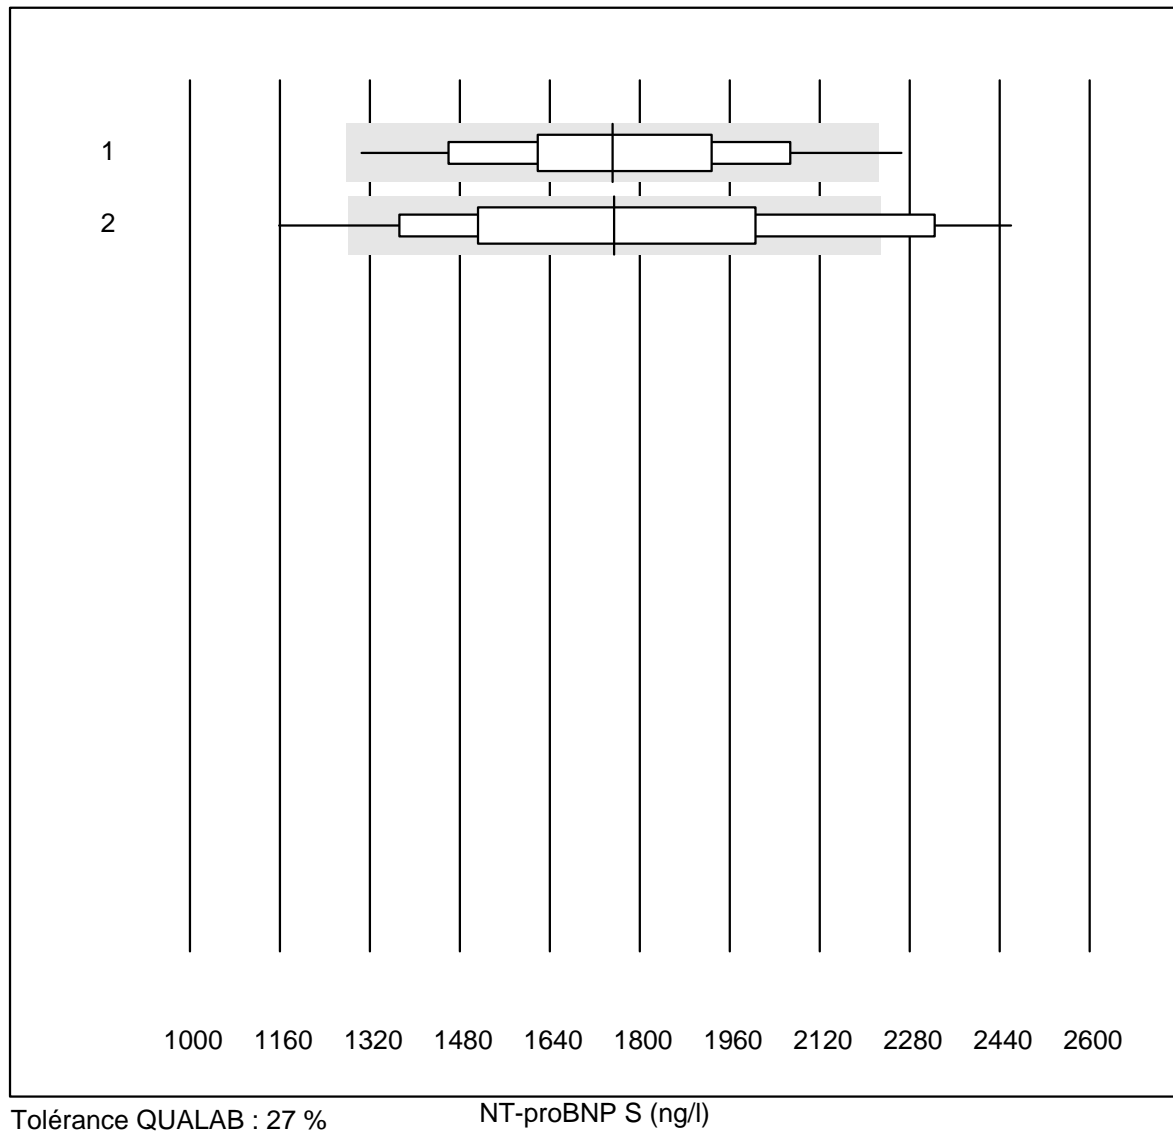


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Samsung LABGEO IB10	35	85.7	5.7	8.6	1751.7	13.8	e
2	AFIAS	37	75.7	21.6	2.7	1754.4	19.7	e

Homocystéine

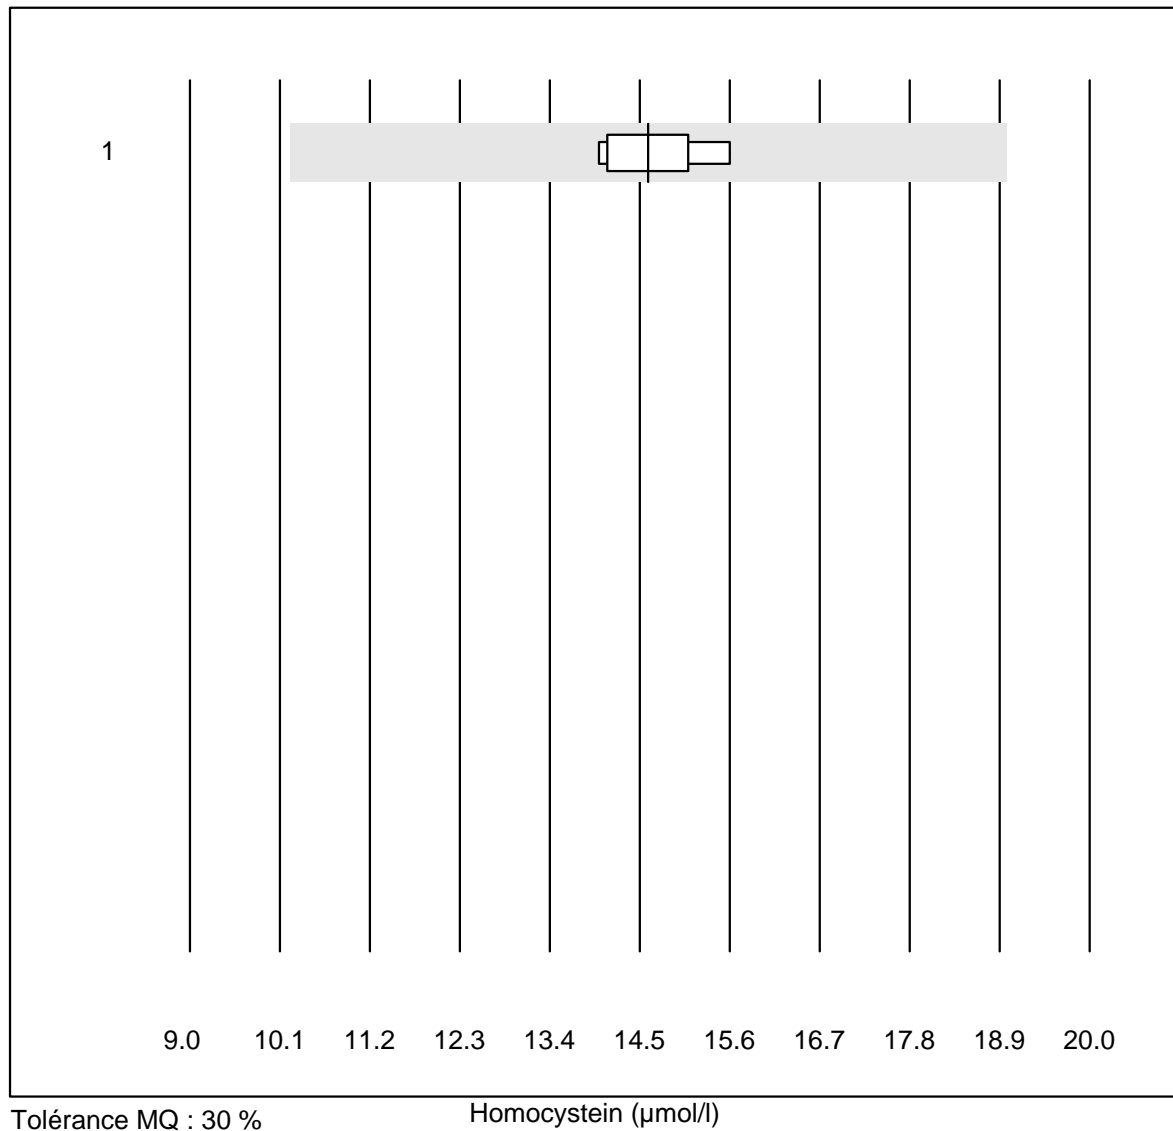

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	14.6	4.3	e

Lipase

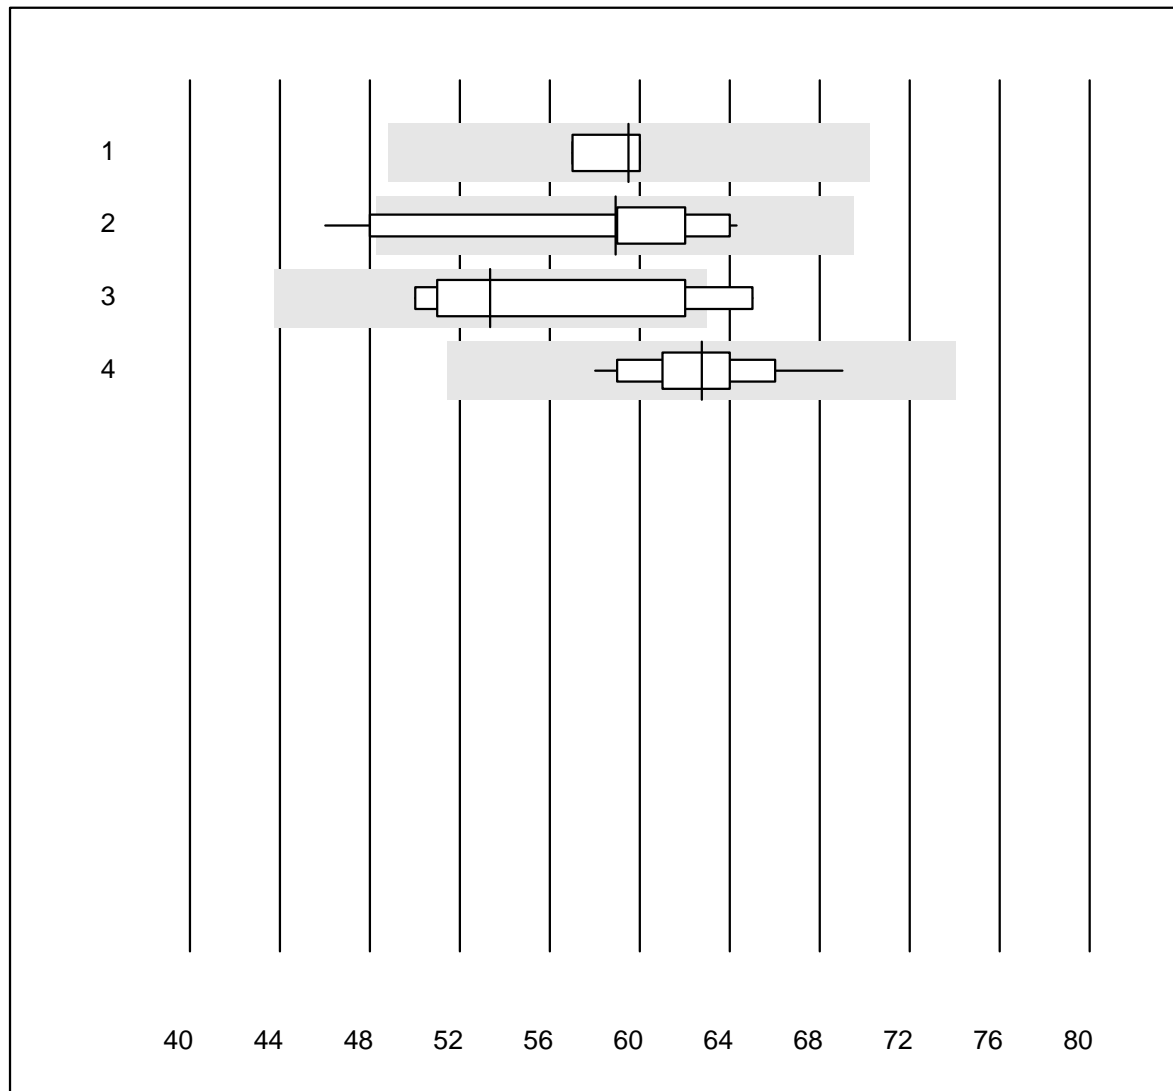


Tolérance QUALAB : 18 %

Lipase (U/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Architect	4	100.0	0.0	0.0	59.5	2.4	e
2 Beckman	13	84.6	15.4	0.0	58.9	9.5	e*
3 Cobas	8	75.0	25.0	0.0	53.4	11.1	e*
4 Fuji Dri-Chem	110	100.0	0.0	0.0	62.8	4.1	e

Cholinestérase

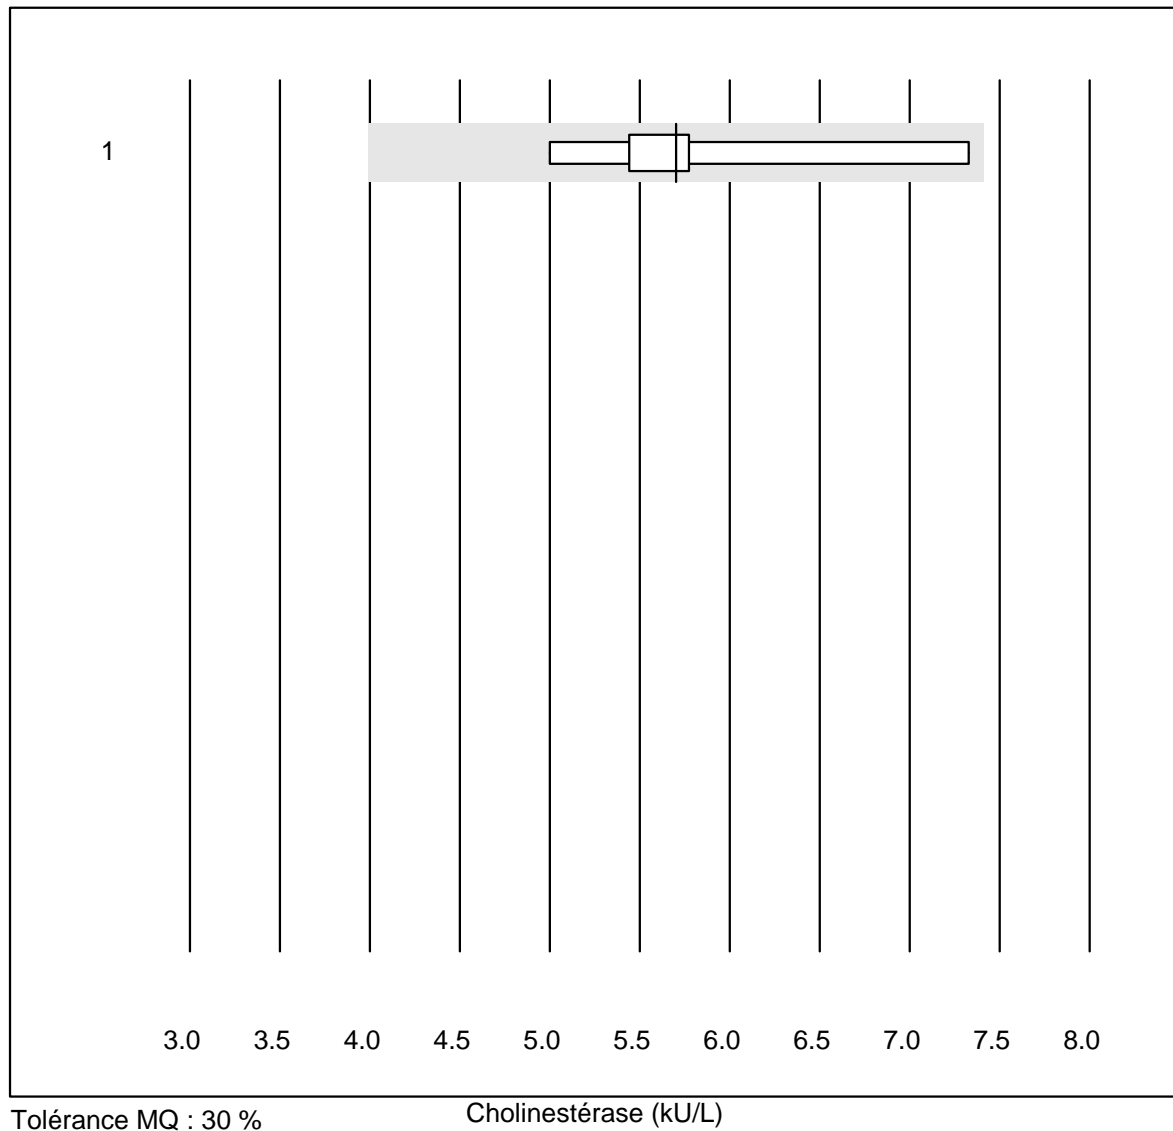


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	5.7	15.2	a

Glucose CSF

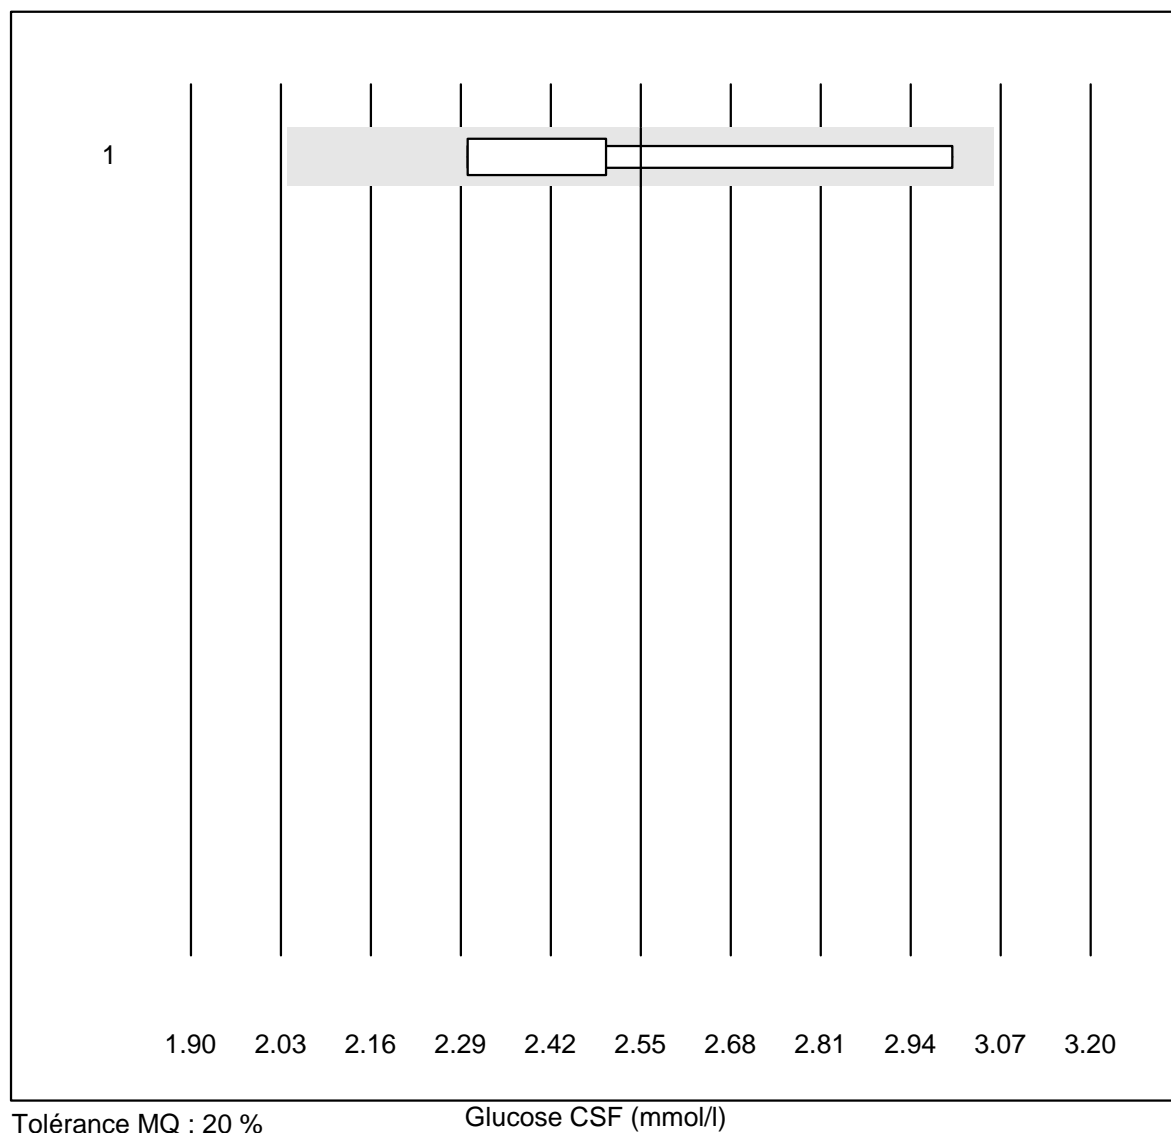


No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	2.55	12.0	a

Lactate CSF

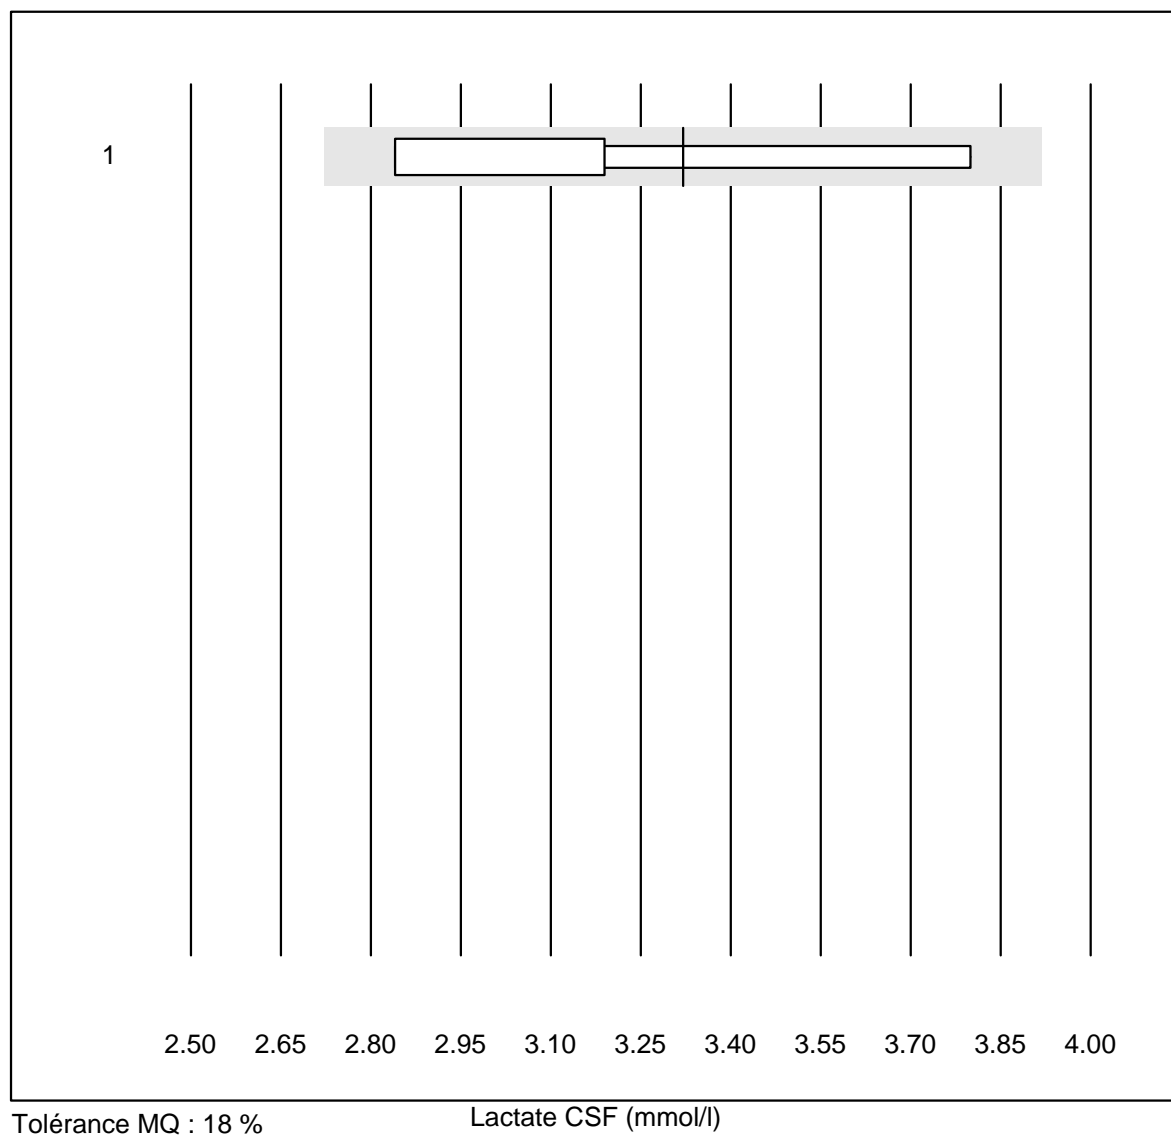


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	3.32	12.4	a

Protéine CSF

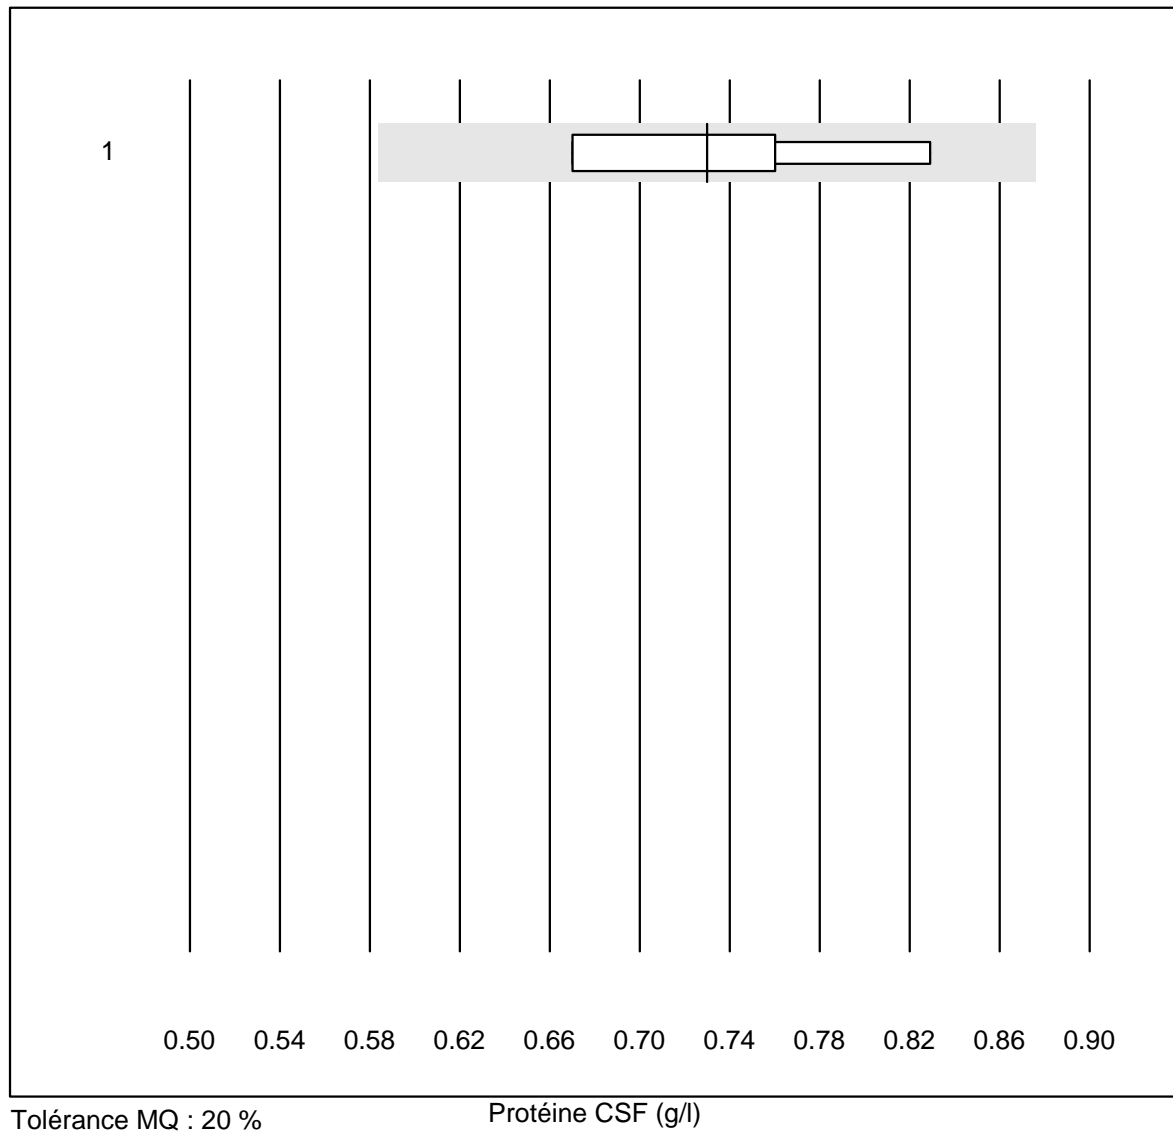


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	0.73	9.5	e*

Tacrolimus

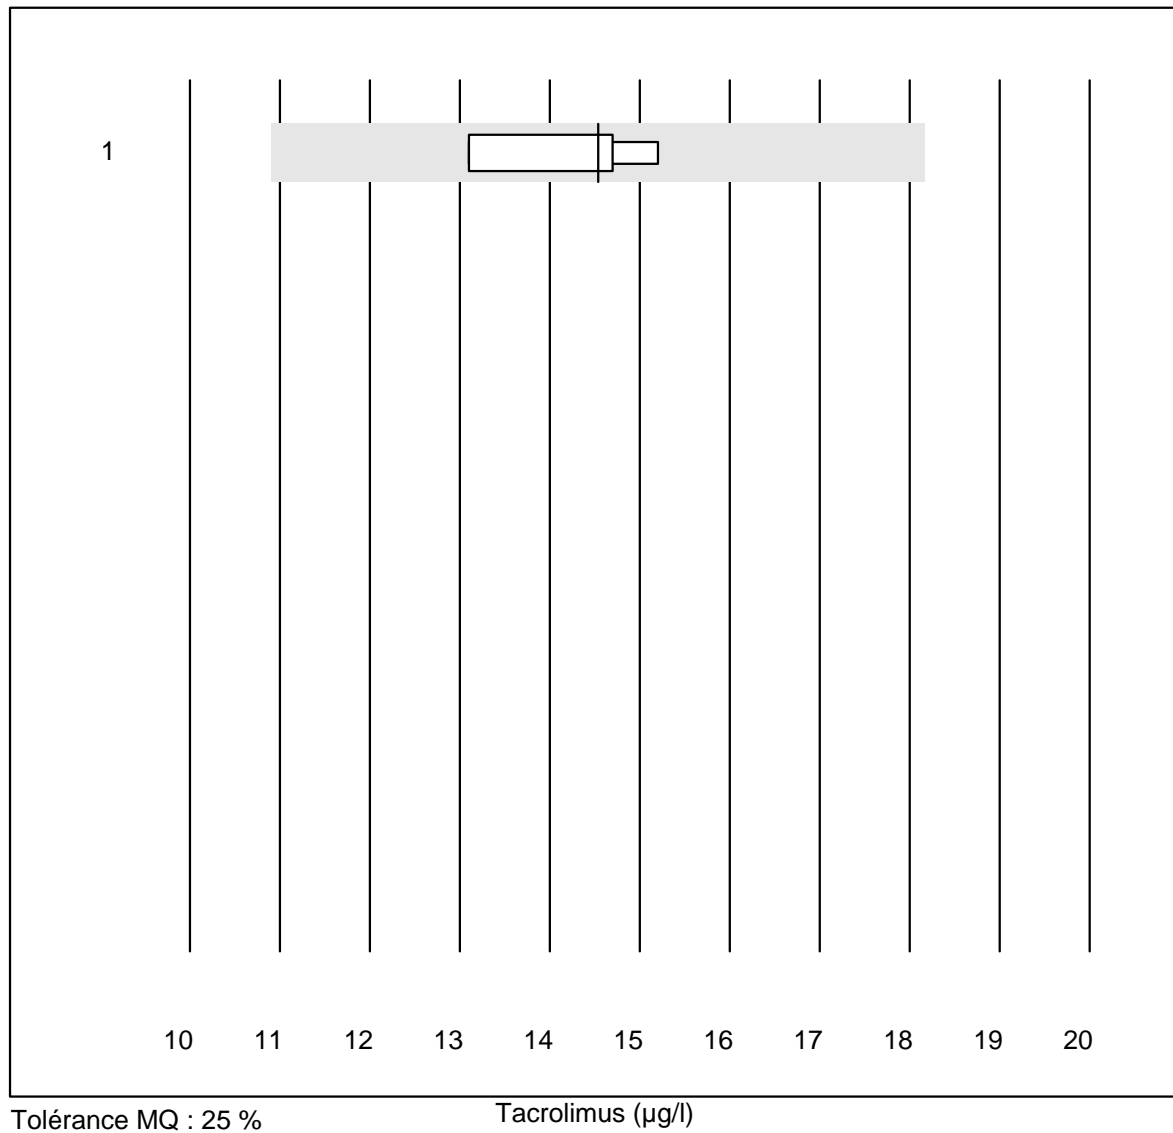

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	14.5	6.2	e*

Totalprotein E

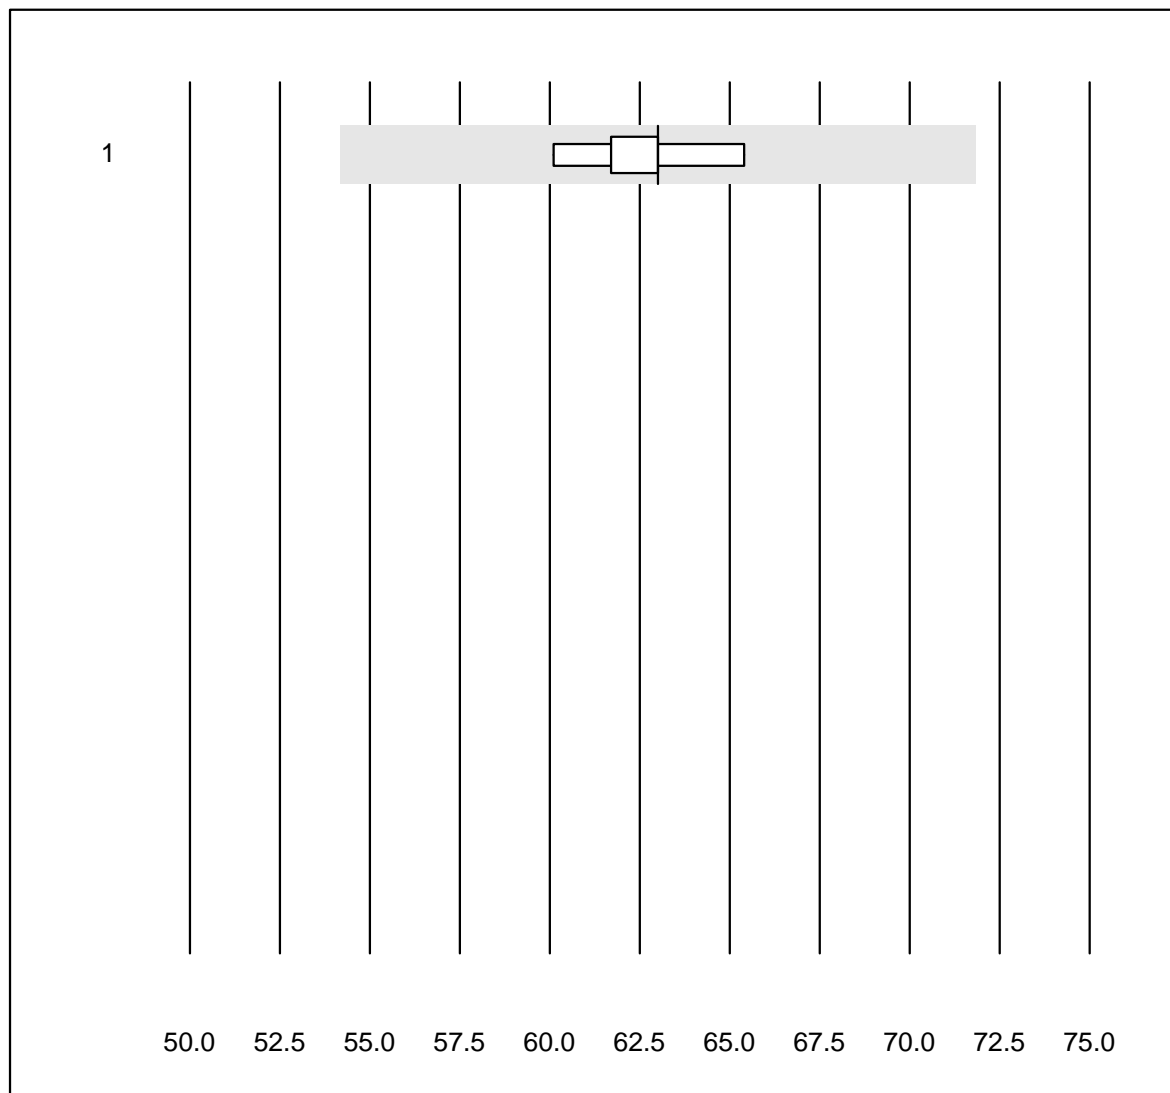


Tolérance MQ : 14 %

Totalprotein E (g/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	63.0	3.1	e

Albumin E

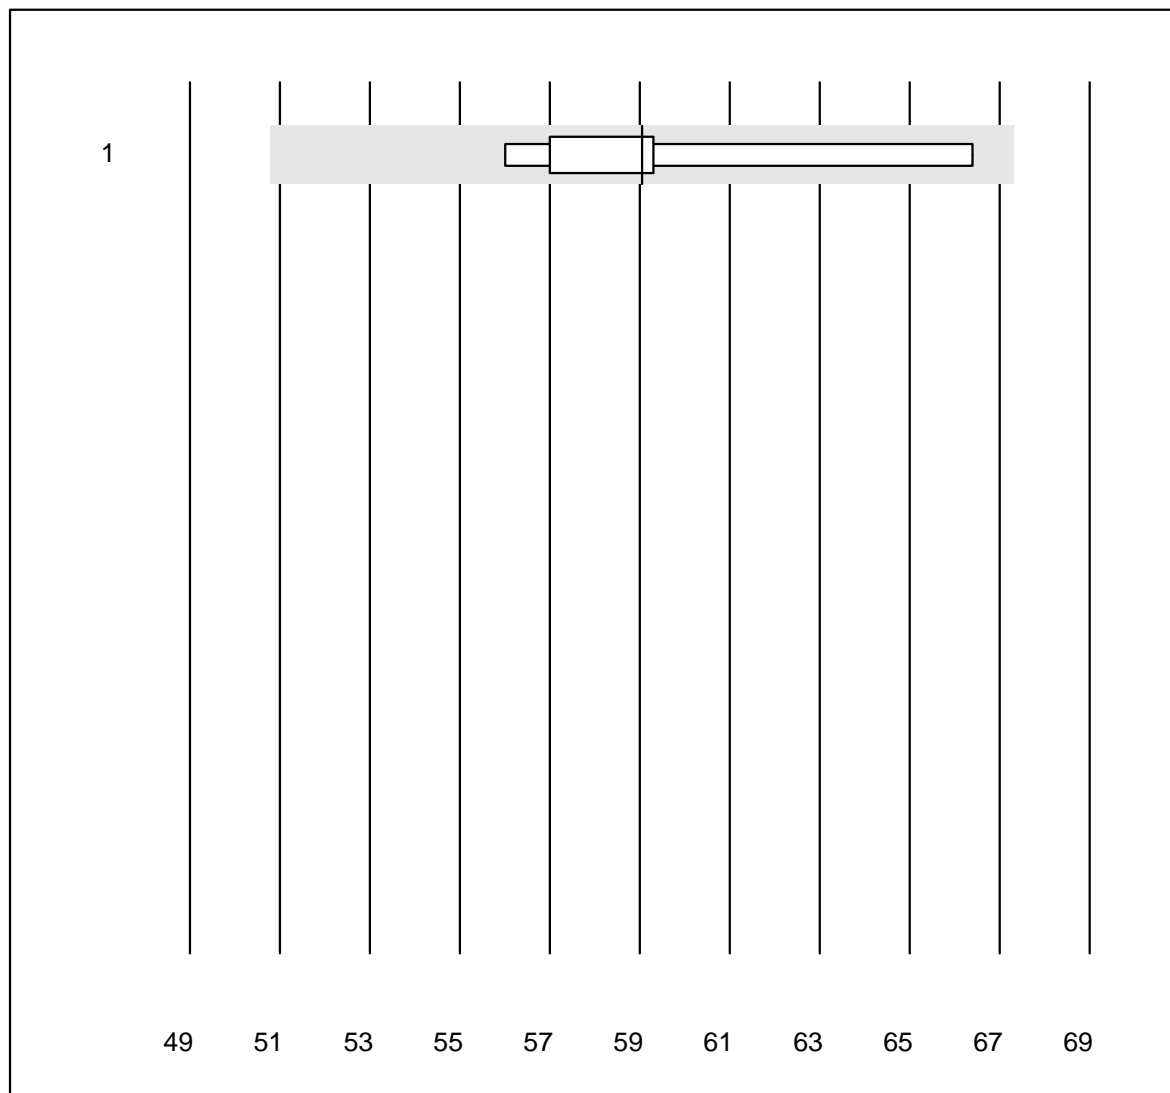


Tolérance MQ : 14 %

Albumin E (%)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Elektrophorese	8	100.0	0.0	0.0	59.1	5.8	e*

alpha-1-Globuline

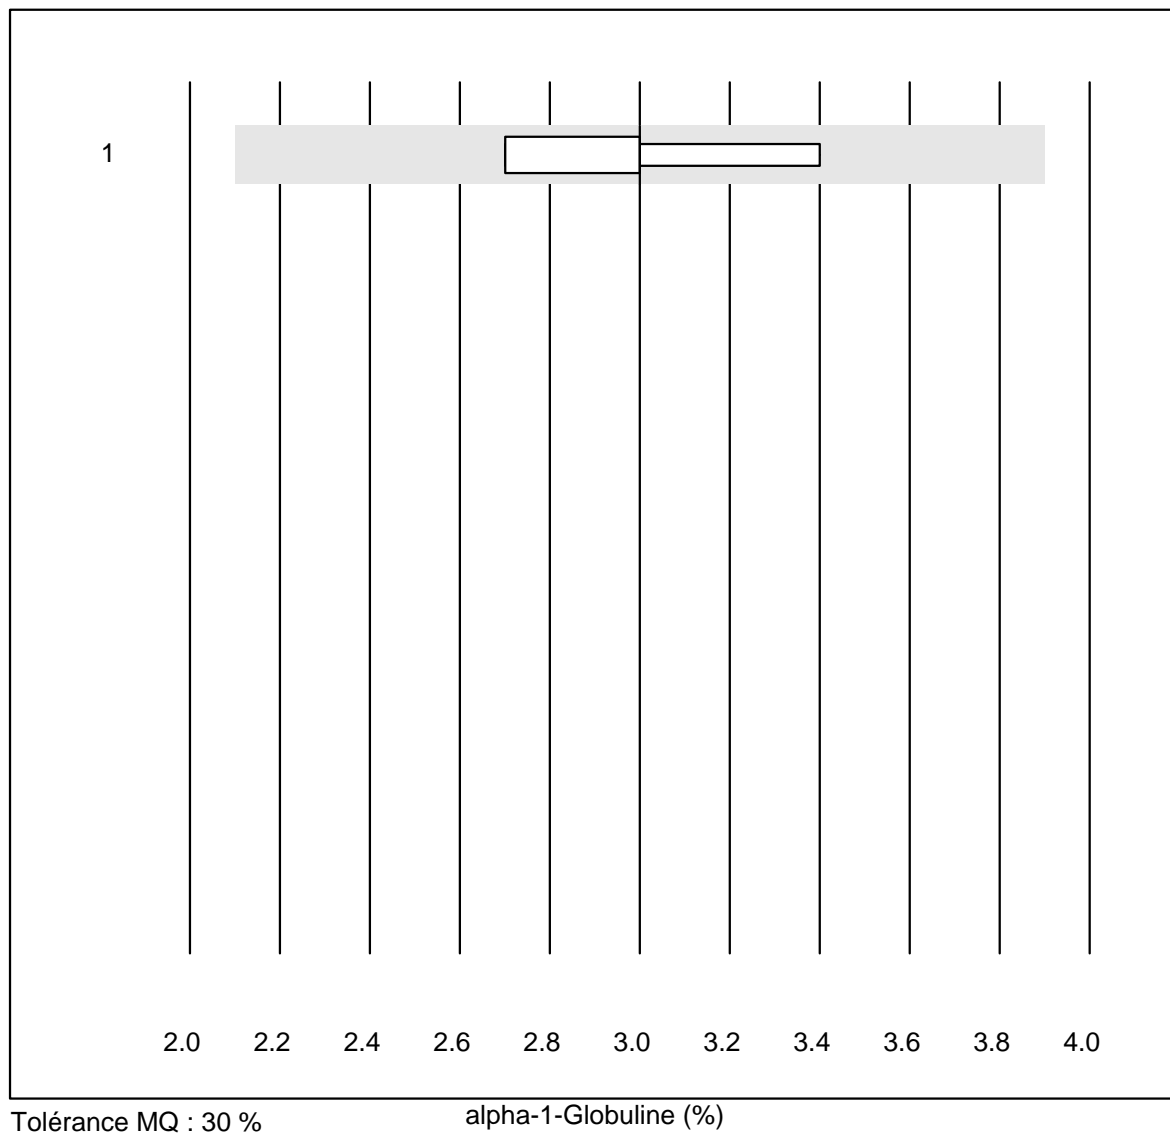


Tolérance MQ : 30 %

alpha-1-Globuline (%)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Elektrophorese	5	80.0	0.0	20.0	3.0	9.8	e*


alpha-2-Globuline

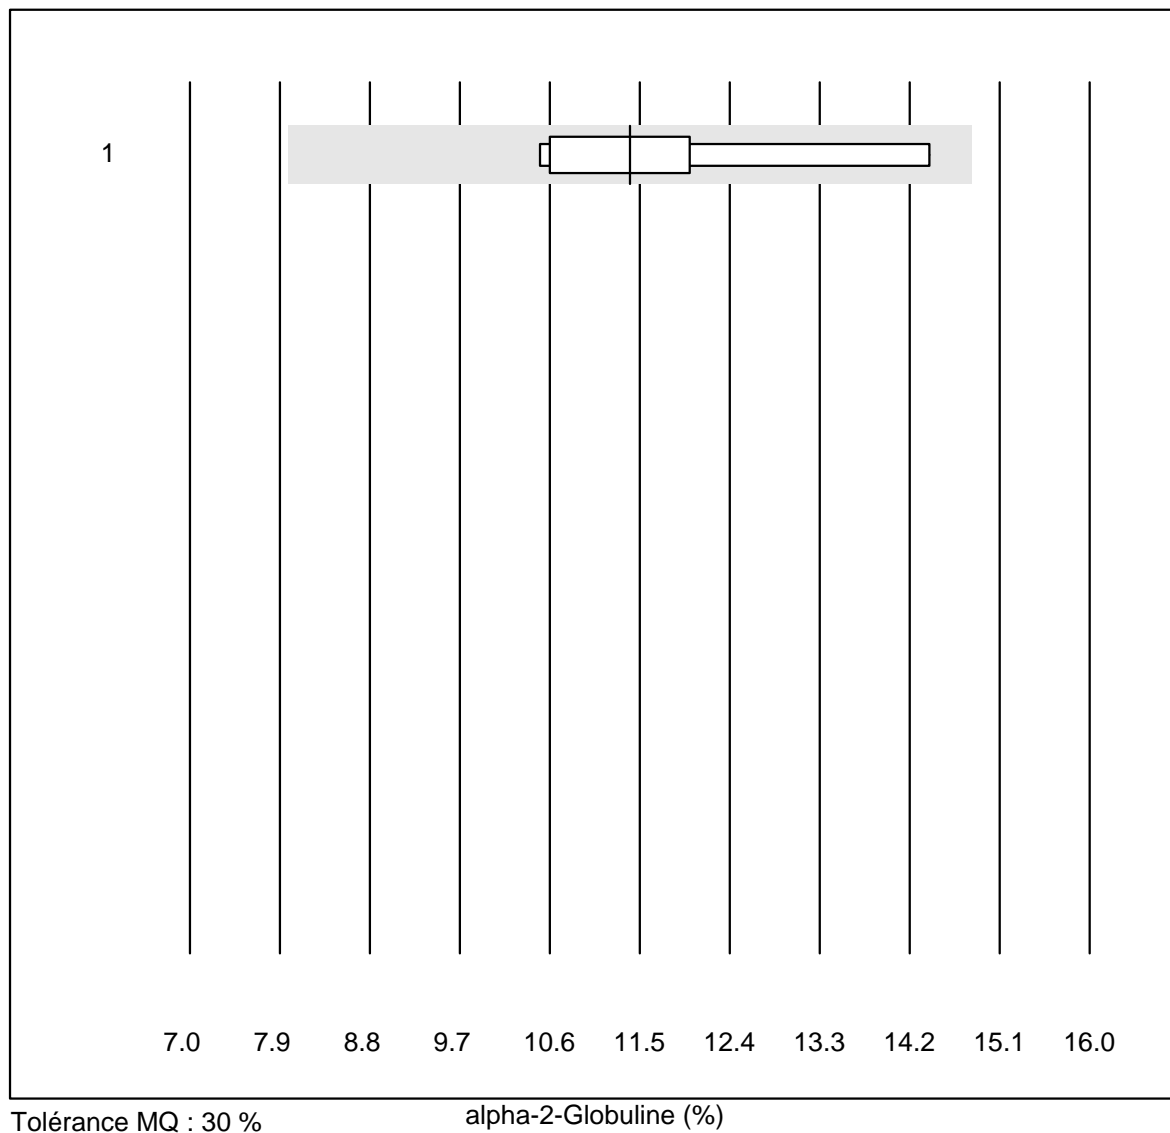

Tolérance MQ : 30 %


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Elektrophorese	8	100.0	0.0	0.0	11.4	10.9	e*

beta-Globuline

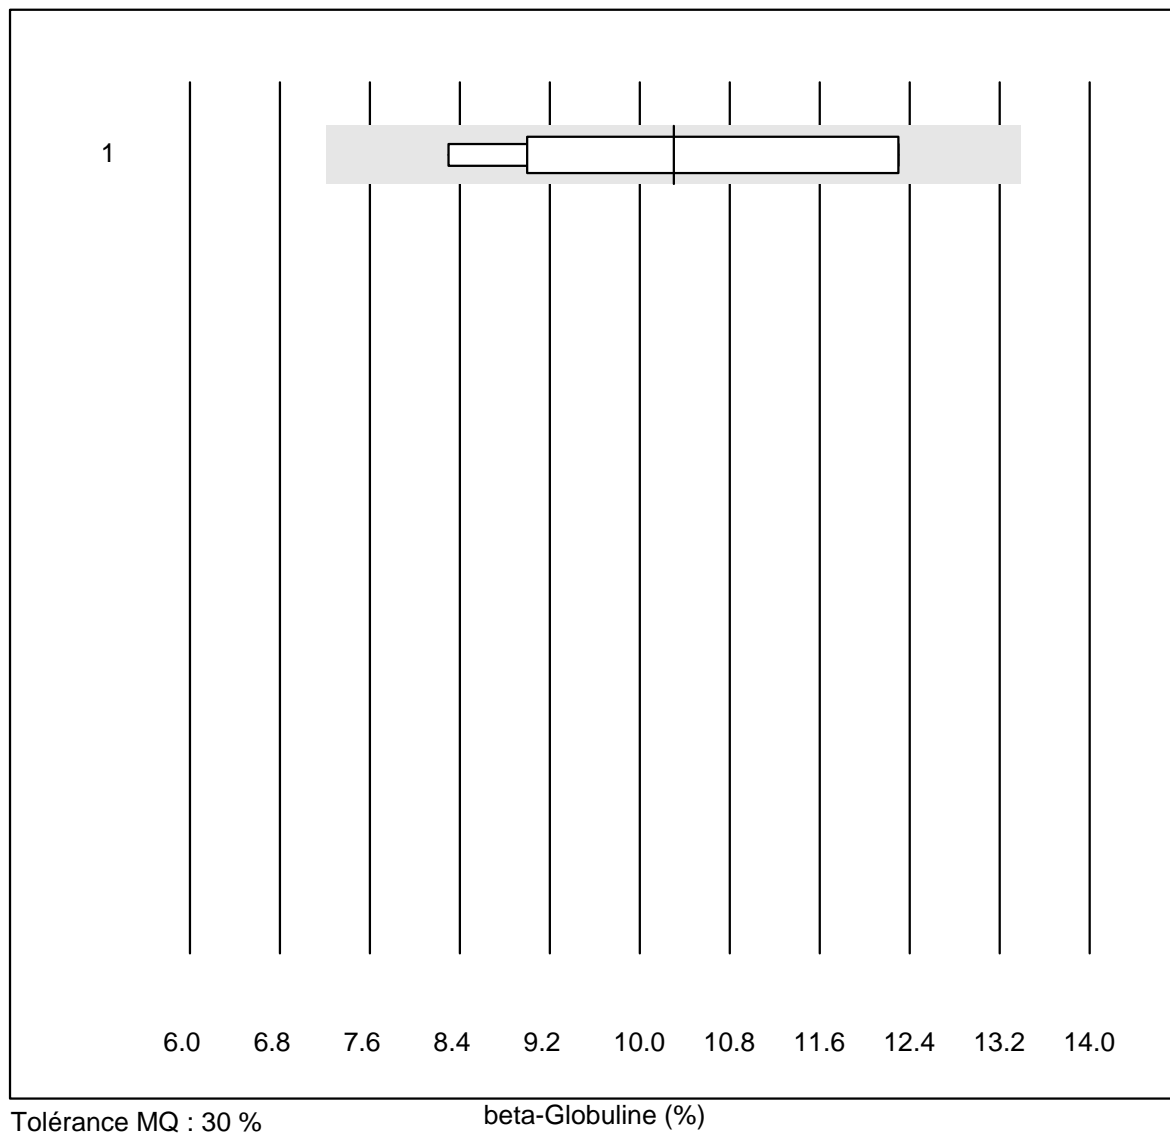

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Elektrophorese	7	100.0	0.0	0.0	10.3	17.5	a

gamma-Globuline

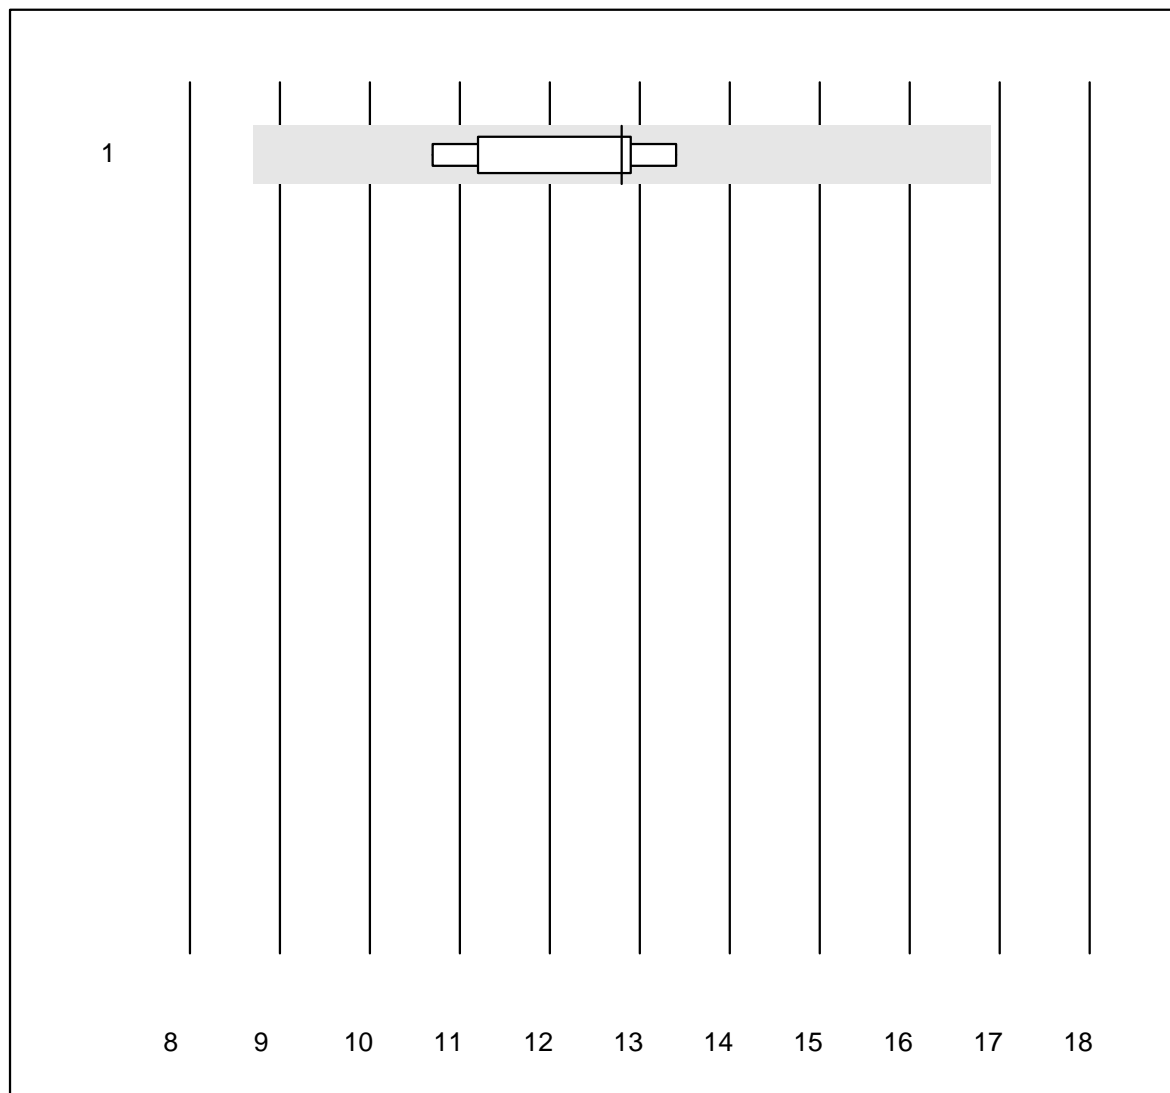


Tolérance MQ : 32 %

gamma-Globuline (%)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Electrophorese	7	85.7	0.0	14.3	12.8	8.6	e

Folates érythrocytaires

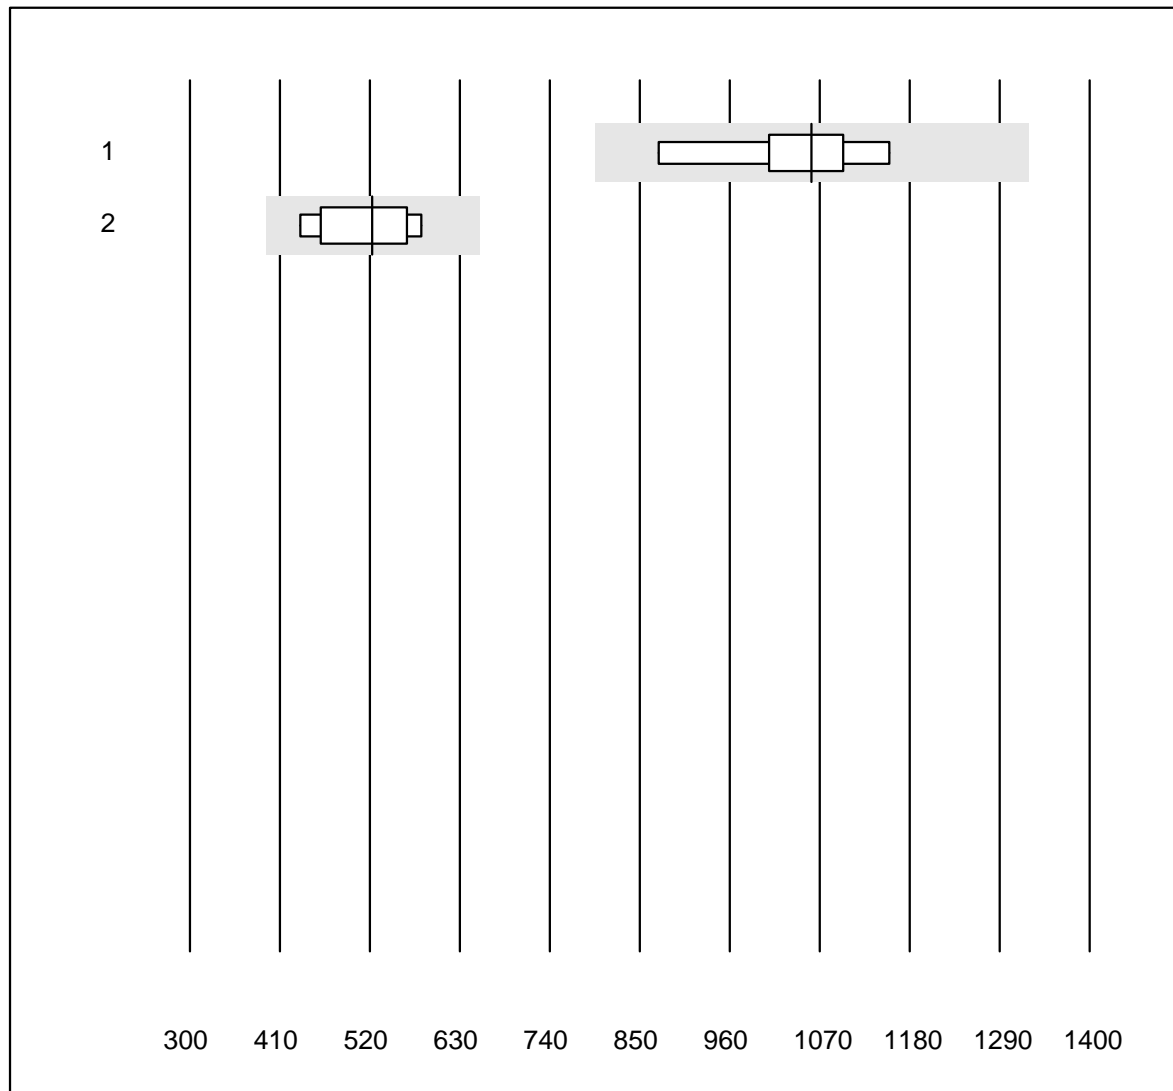


Tolérance MQ : 25 %

Folates érythrocytaires (nmol/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Beckman	5	100.0	0.0	0.0	1060	10.3	e*
2 Architect	7	100.0	0.0	0.0	523	10.5	e*

Gallensäure

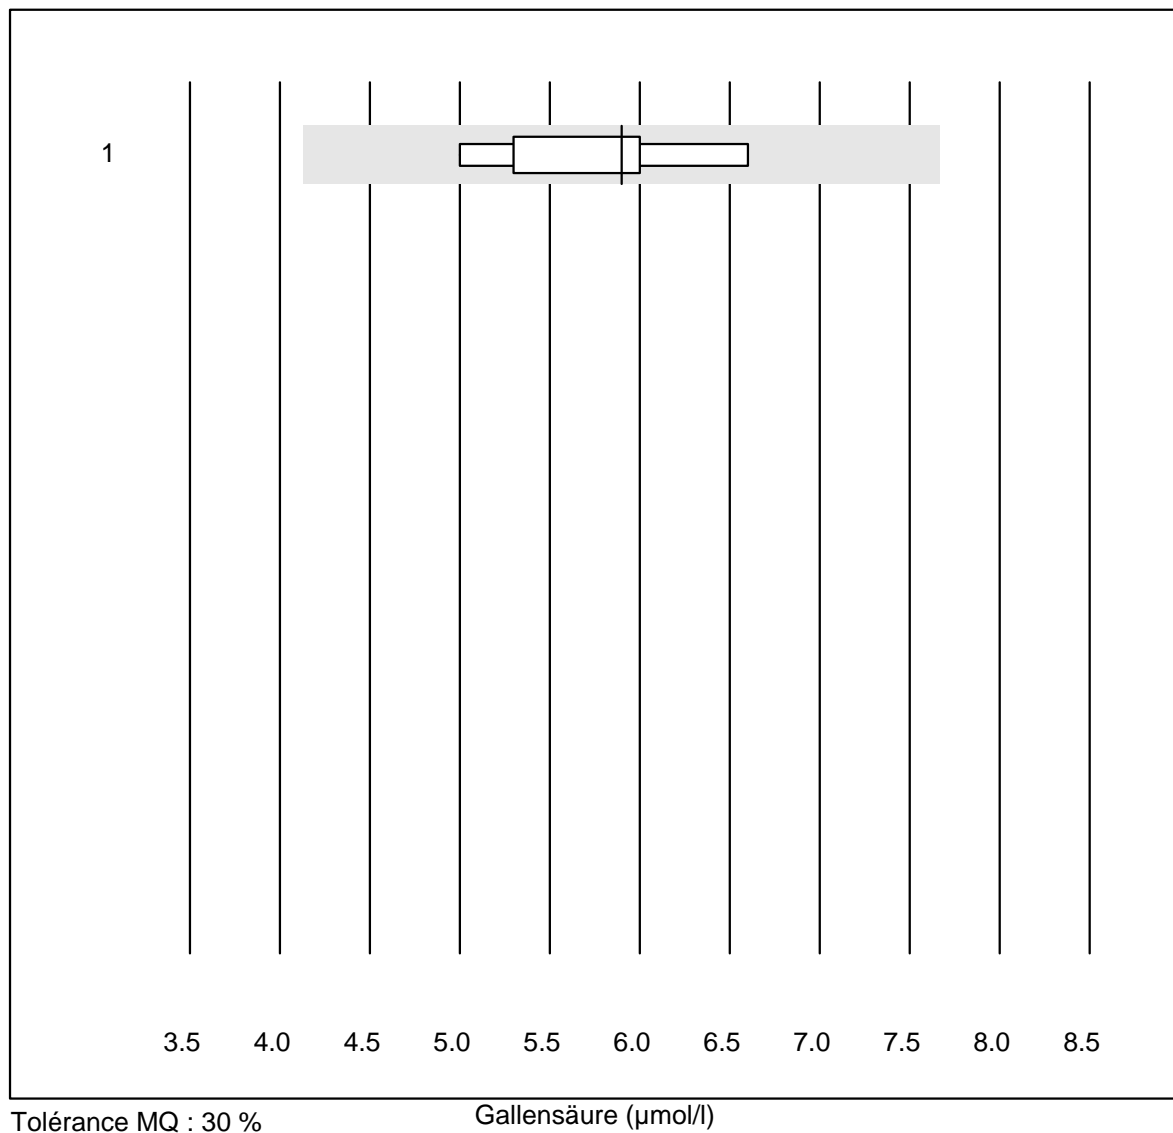

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	6	83.3	0.0	16.7	6	10.9	e*

BNP

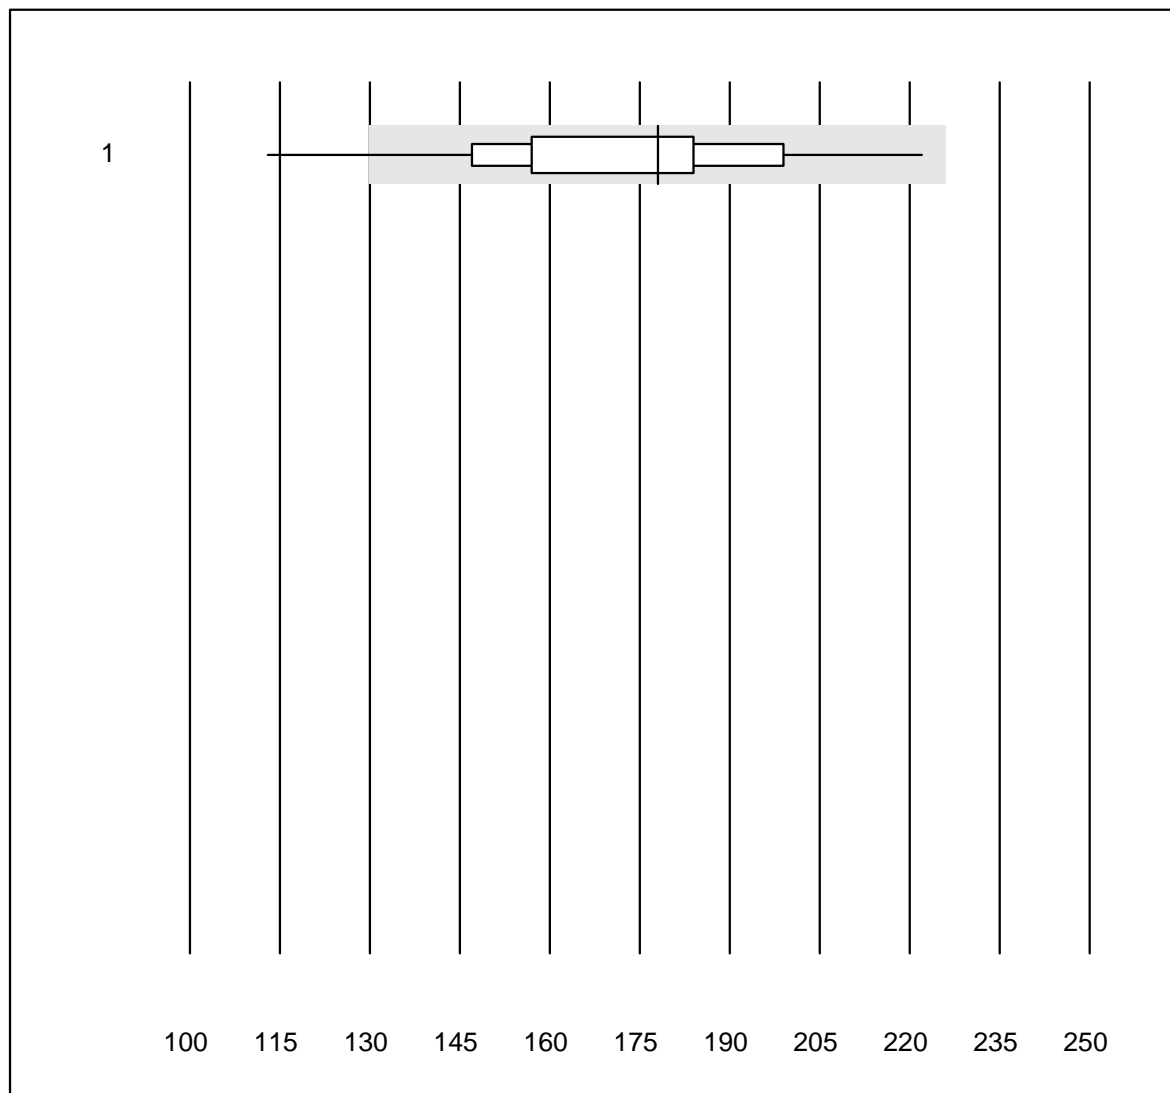


Tolérance QUALAB : 27 %

BNP (ng/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Triage	37	89.2	2.7	8.1	178.0	12.2	e

Troponin Triage

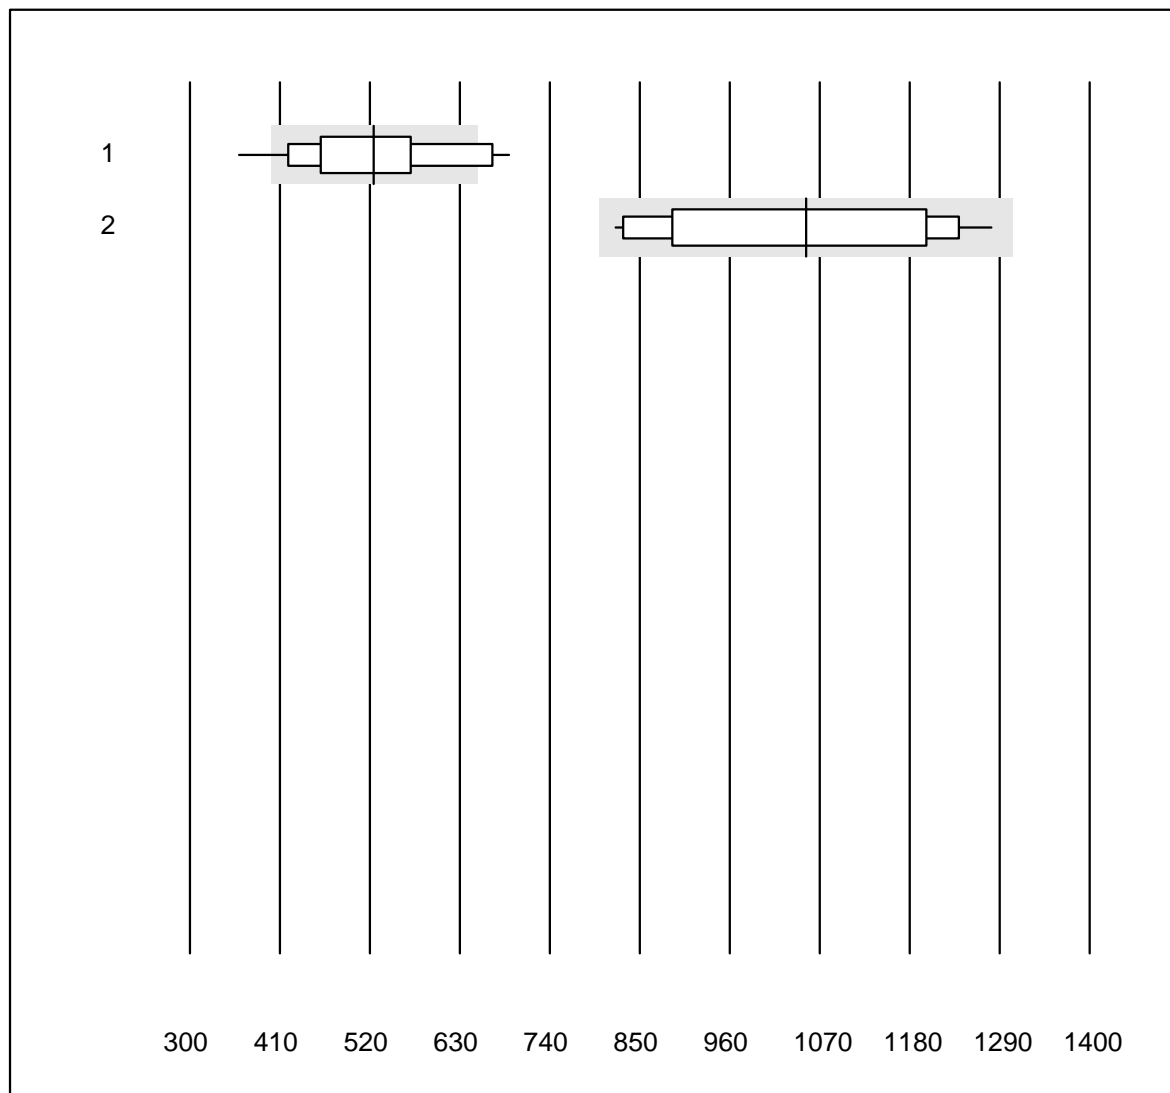


Tolérance QUALAB : 24 %

Troponin Triage (ng/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Triage Next Gen	36	58.3	16.7	25.0	525.00	17.4	e*
2	Triage SOB/Cardiac	16	93.7	0.0	6.3	1053.33	14.6	e*

NT-proBNP

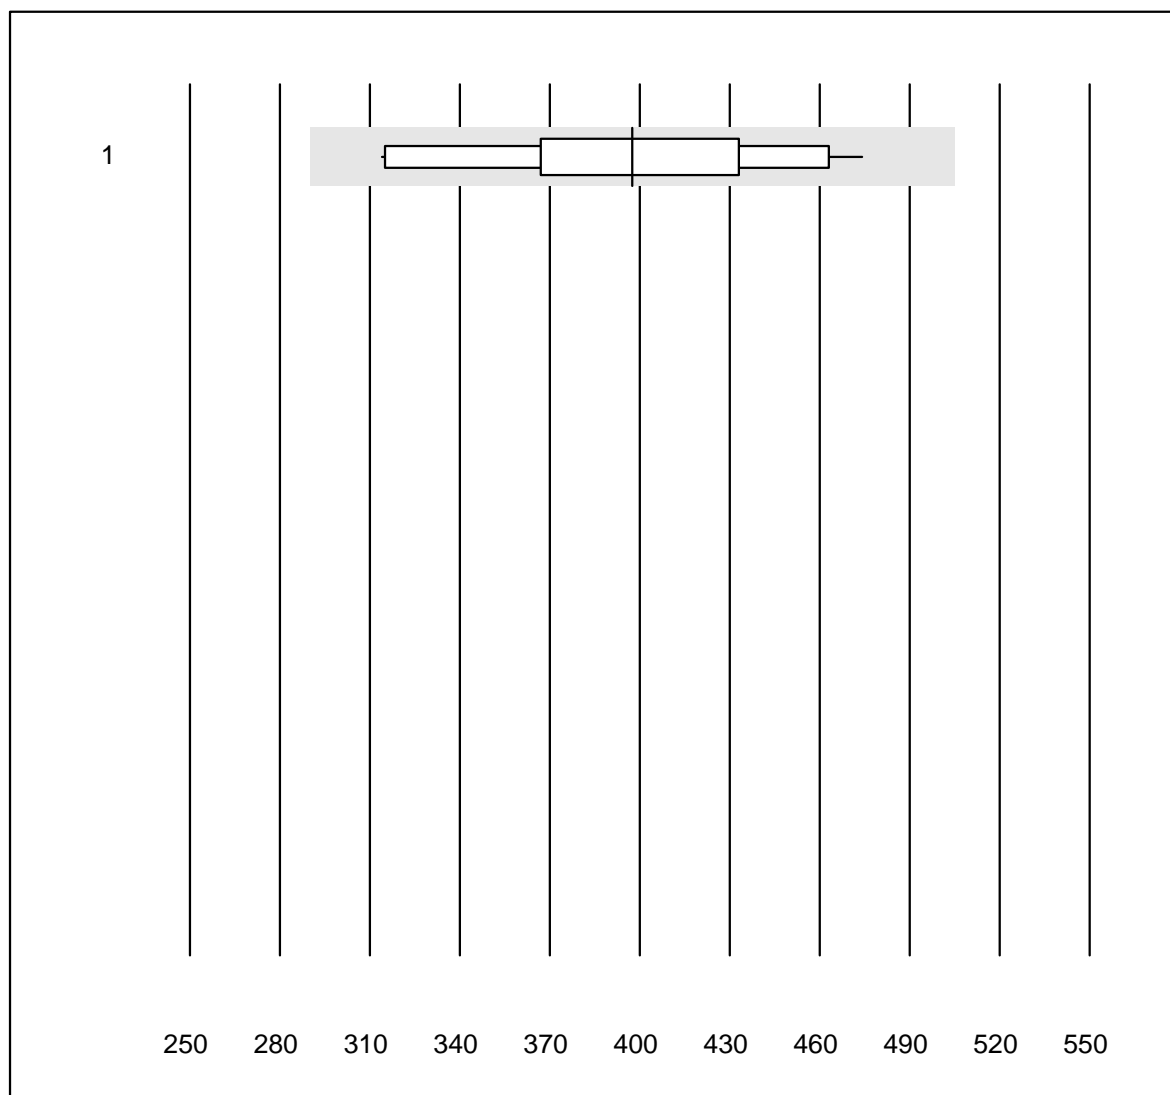


Tolérance QUALAB : 27 %

NT-proBNP (ng/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Triage	17	100.0	0.0	0.0	398	12.3	e


D-Dimere Triage

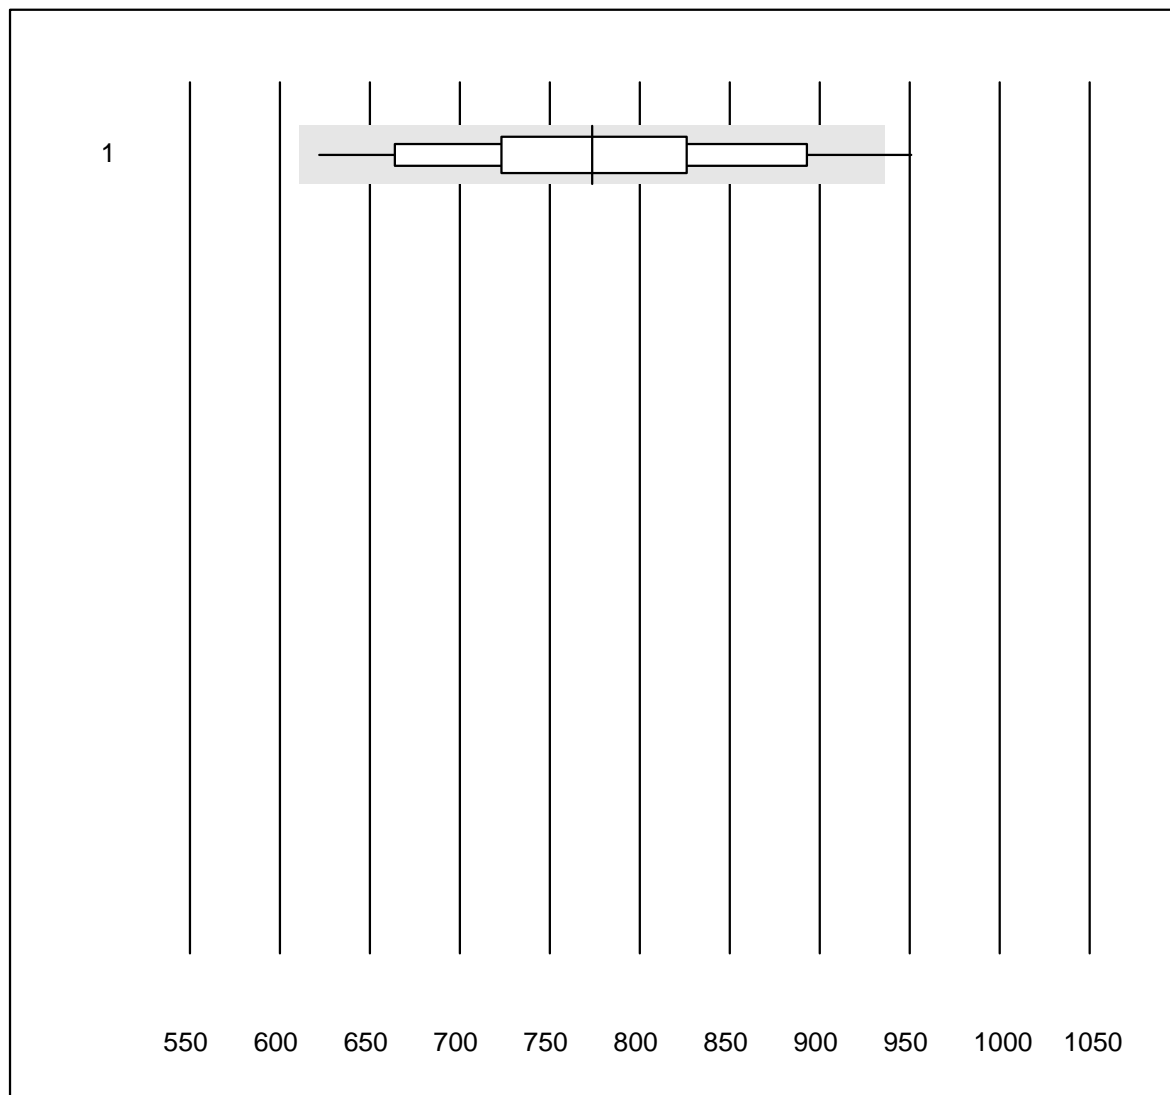

Tolérance QUALAB : 21 % D-Dimere Triage (ng/ml)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Triage	50	96.0	4.0	0.0	773.58	10.3	e

CK-MB Triage

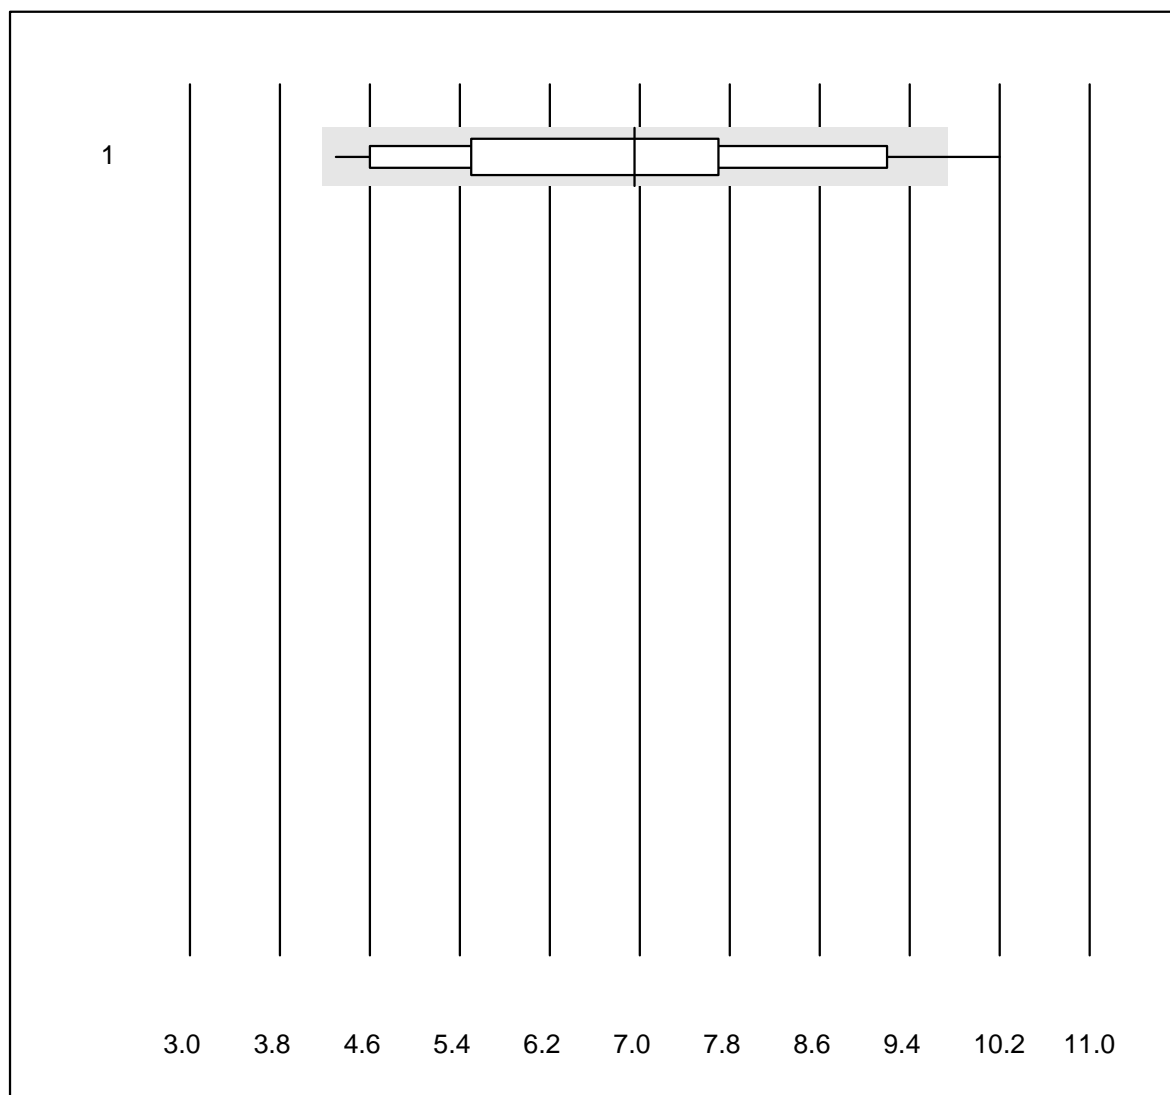


Tolérance MQ : 40 %

CK-MB Triage (µg/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Triage	16	93.7	6.3	0.0	7.0	23.9	e*

Myoglobin Triage

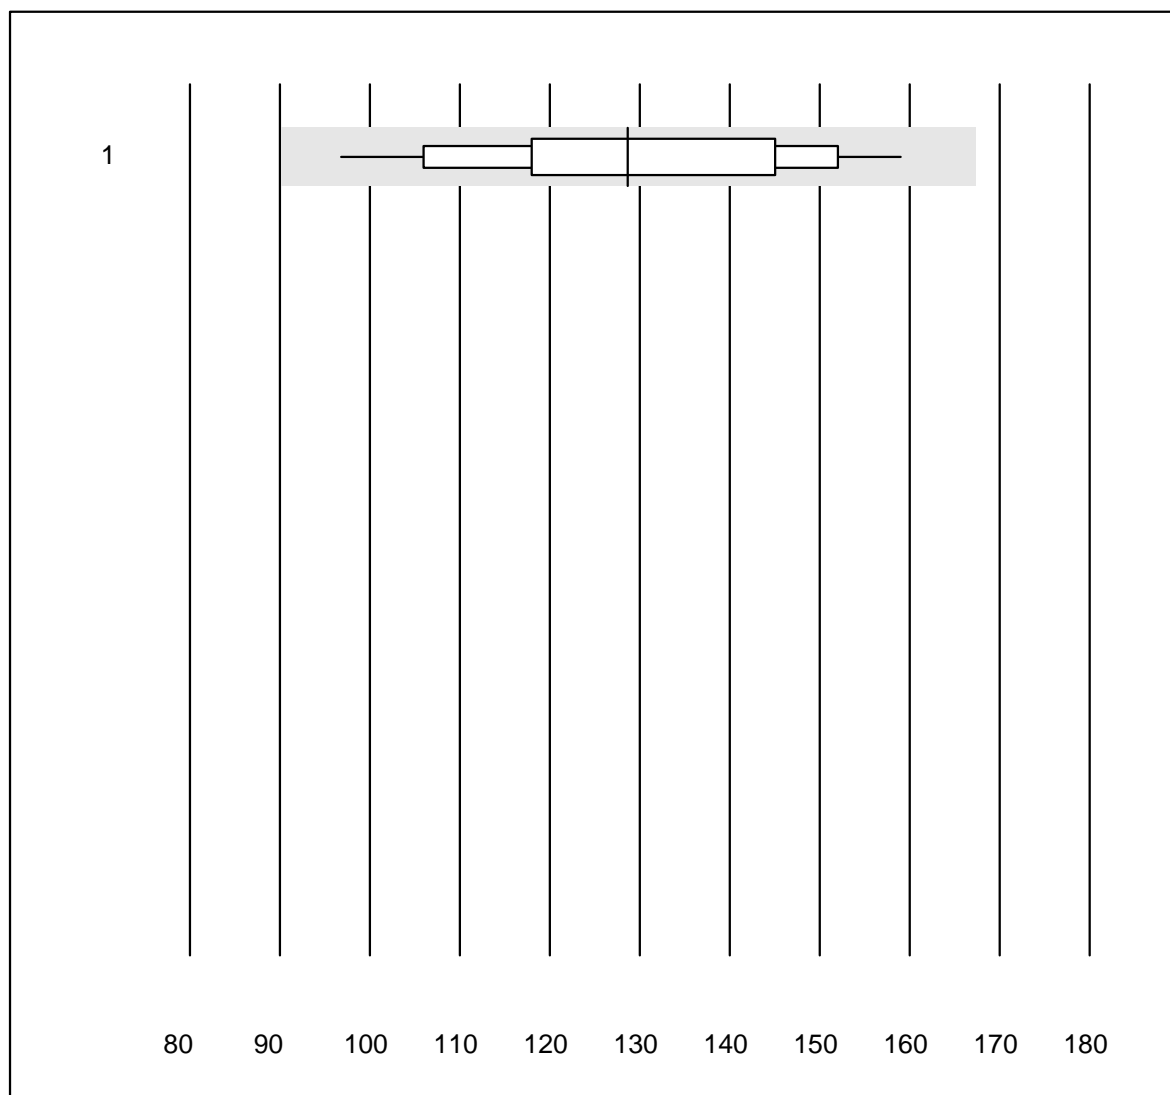


Tolérance QUALAB : 30 %

Myoglobin Triage (µg/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Triage	13	100.0	0.0	0.0	128.7	14.6	e*

25-OH Vitamin D

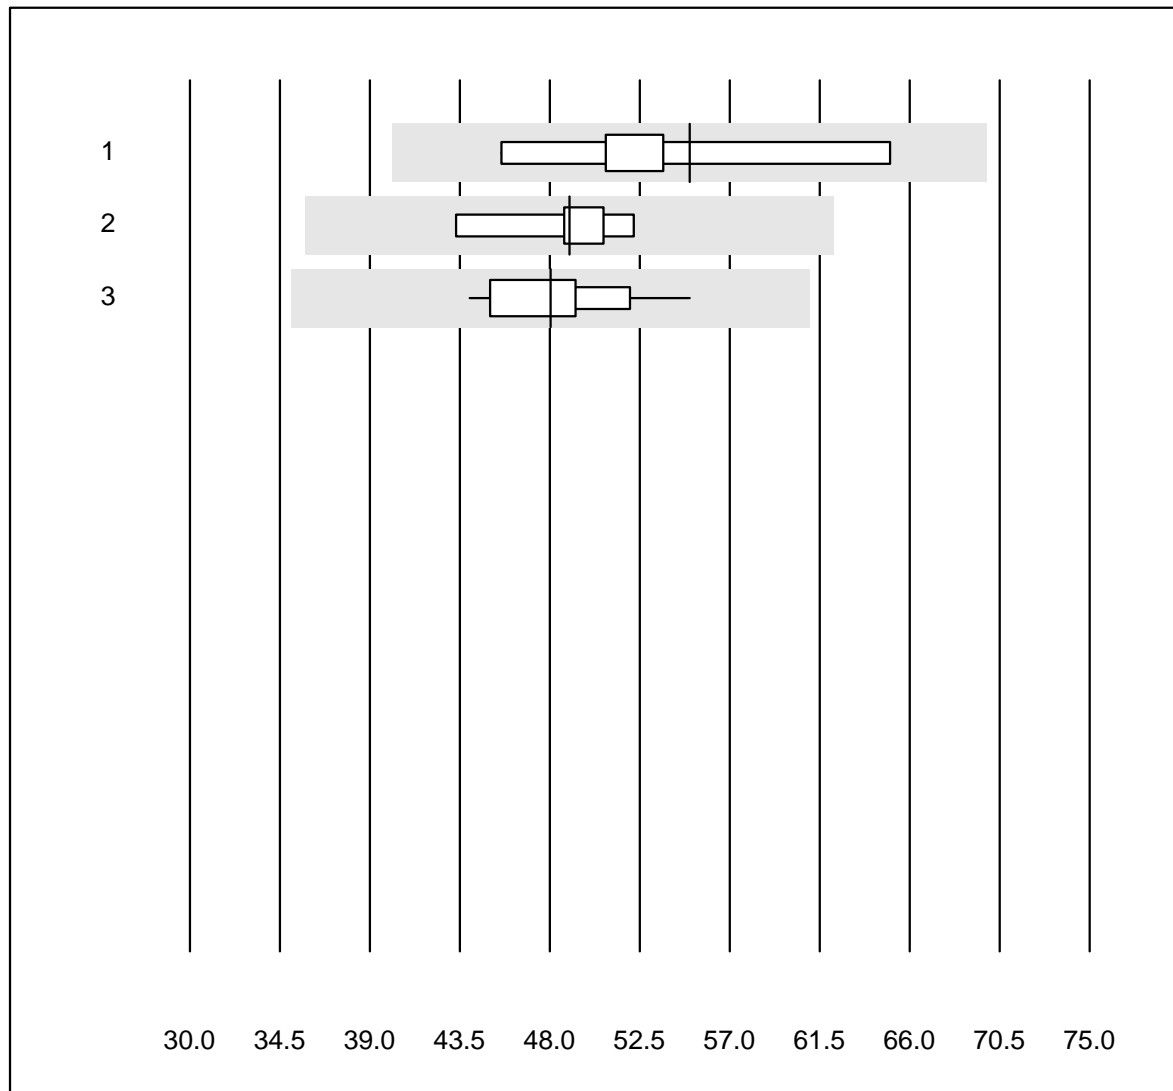


Tolérance QUALAB : 27 %

25-OH Vitamin D (nmol/l)


No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	55.0	13.6	a
2 VIDAS	5	100.0	0.0	0.0	49.0	6.9	e
3 Architect	11	100.0	0.0	0.0	48.0	6.9	e

AMH

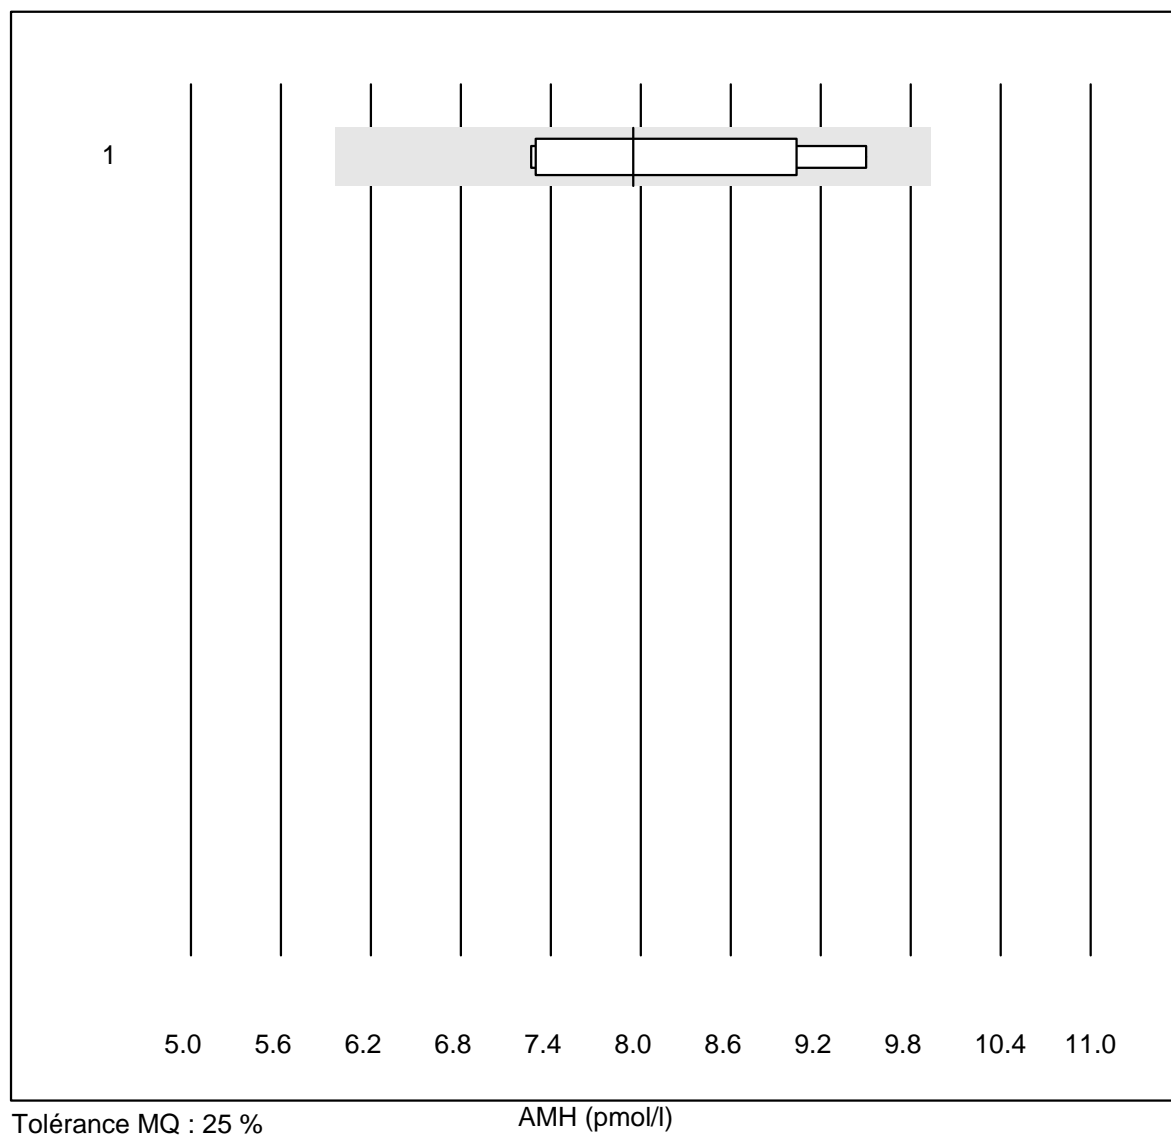


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	8	100.0	0.0	0.0	8.0	10.7	e*

Calcitonin

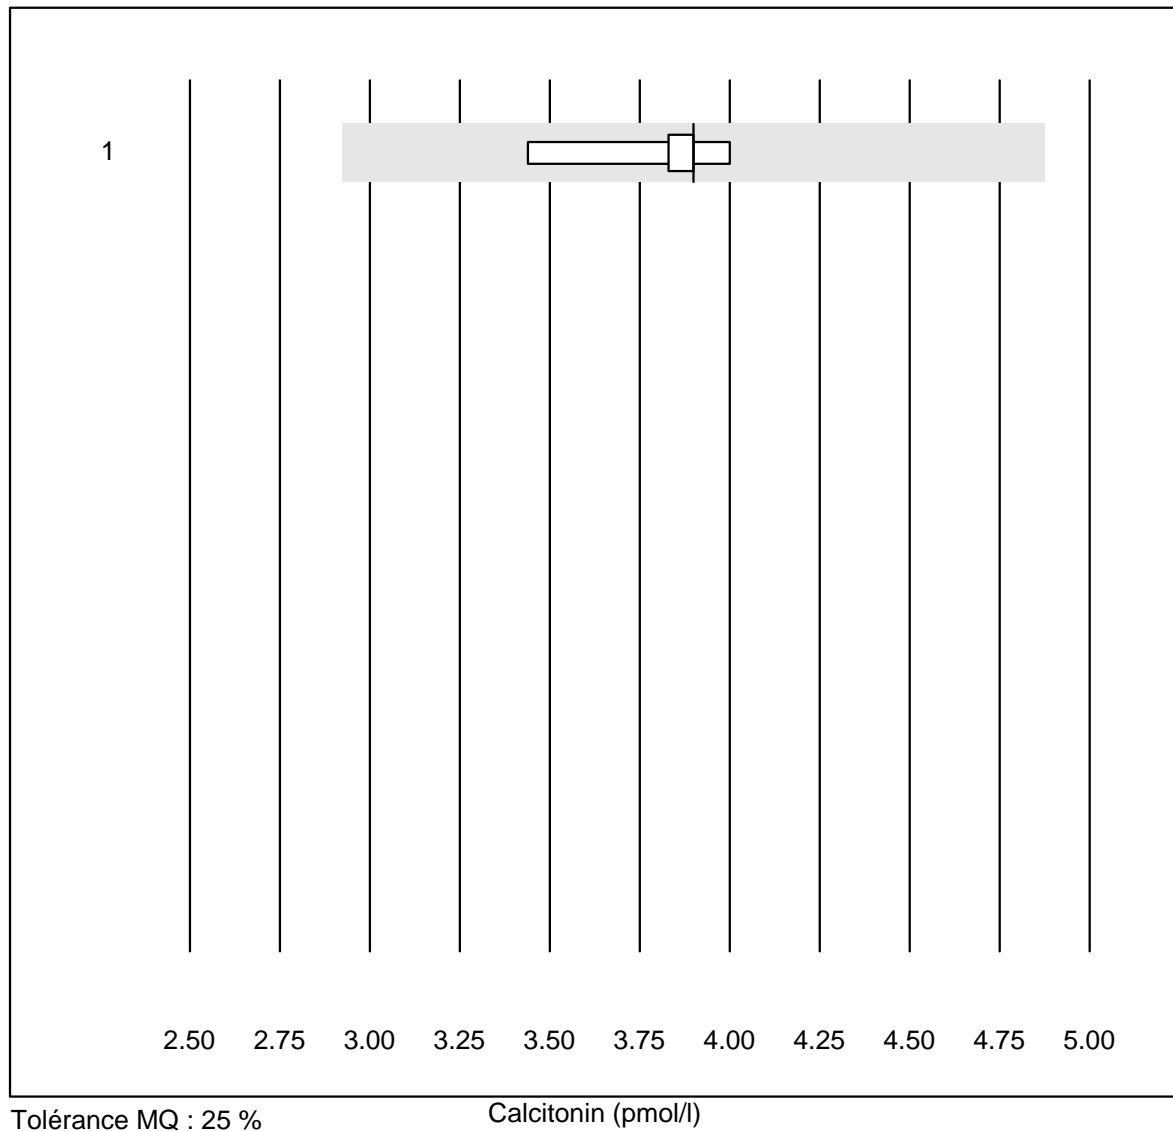

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Liaison	5	100.0	0.0	0.0	3.9	5.7	e

TRAK

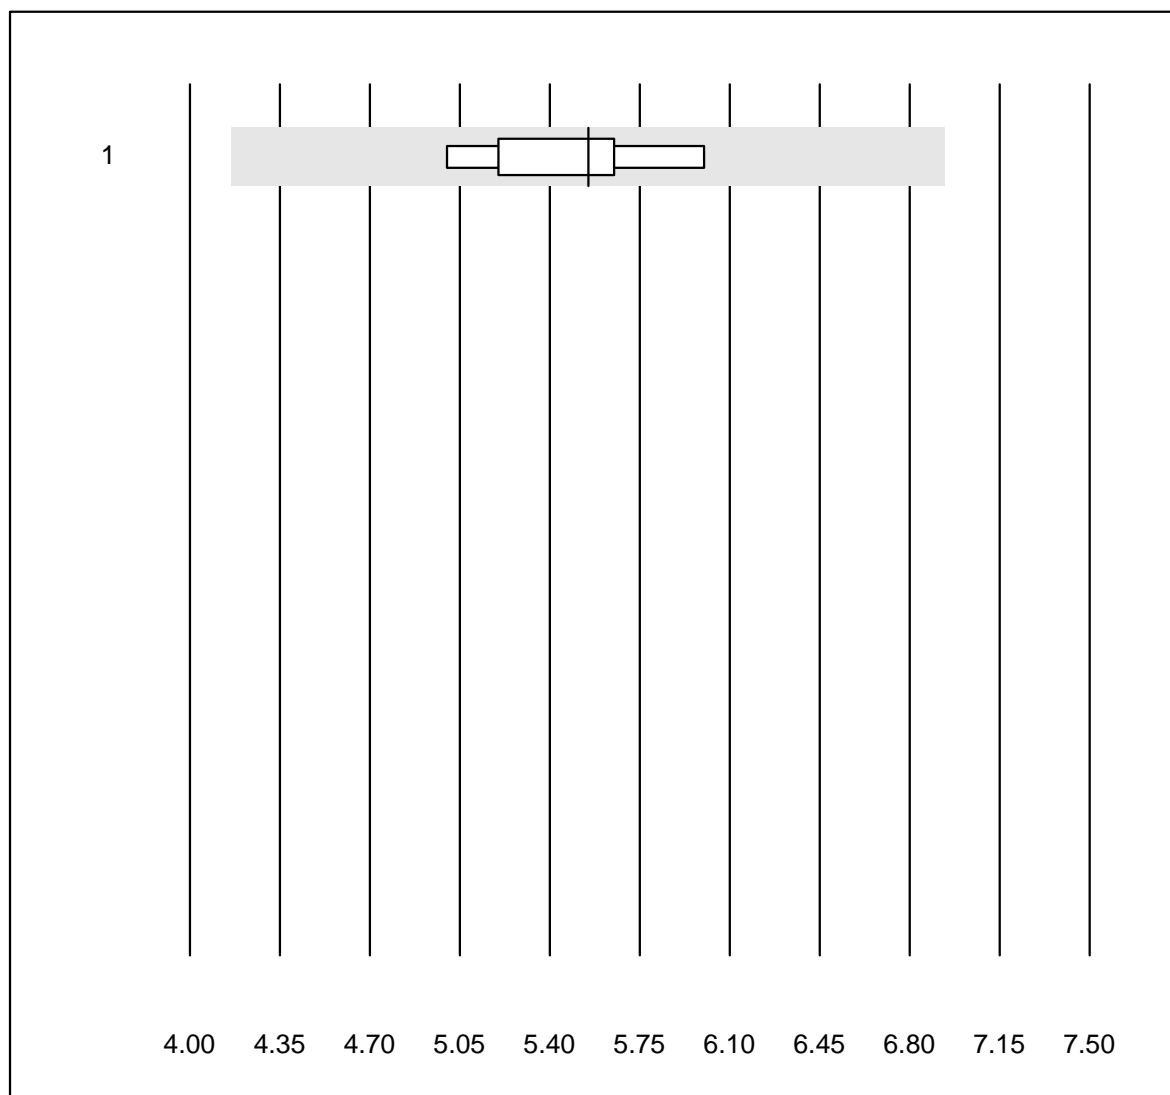


Tolérance MQ : 25 %

TRAK (IE/ml)

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	6	6.4	e

Amylase-urine

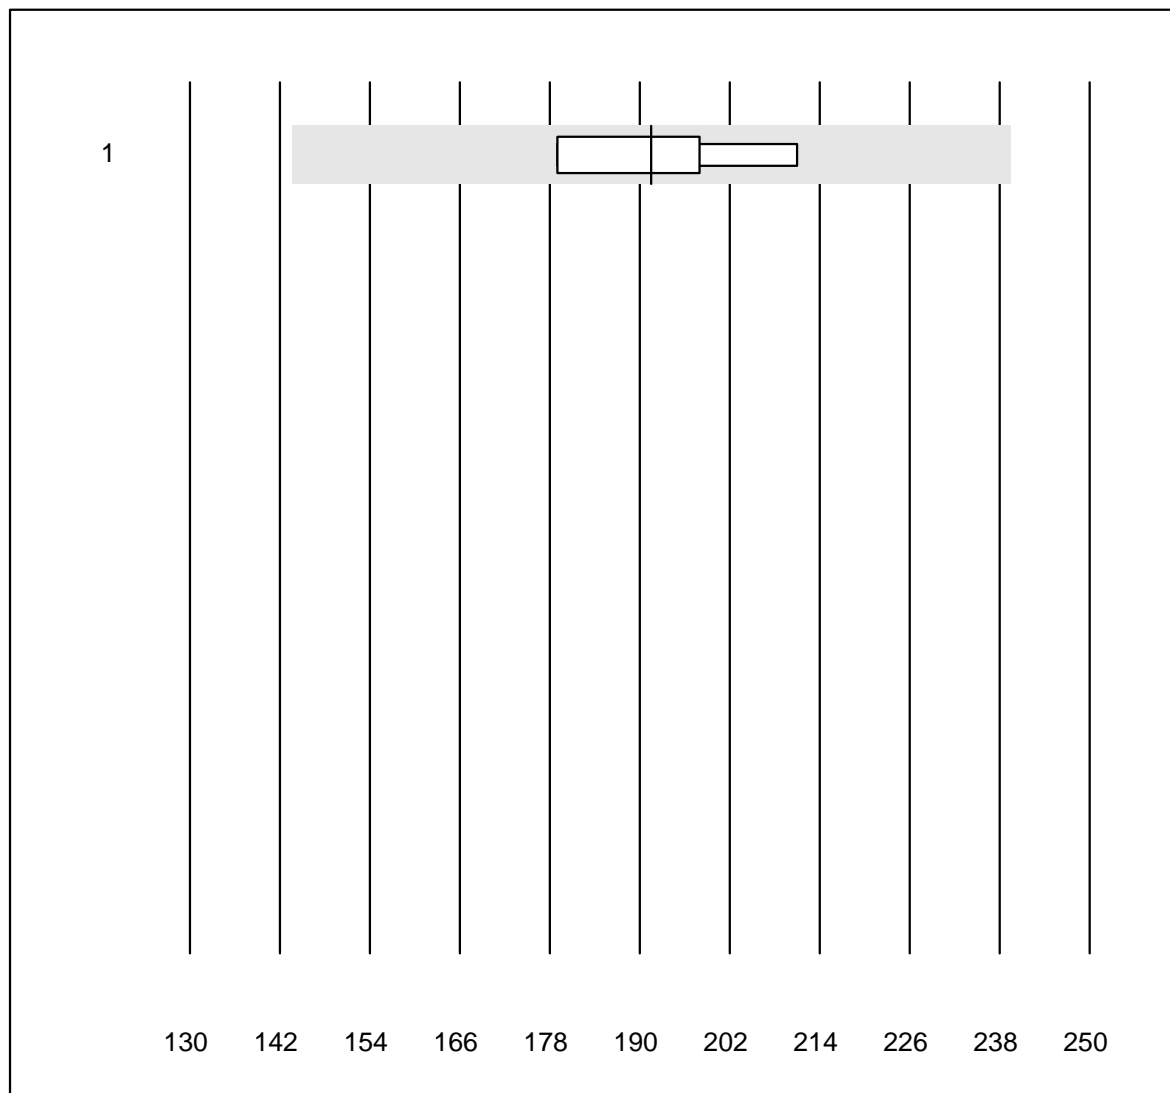


Tolérance MQ : 25 %

Amylase-urine (U/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 IFCC	4	100.0	0.0	0.0	192	7.4	e*

Calcium-urine

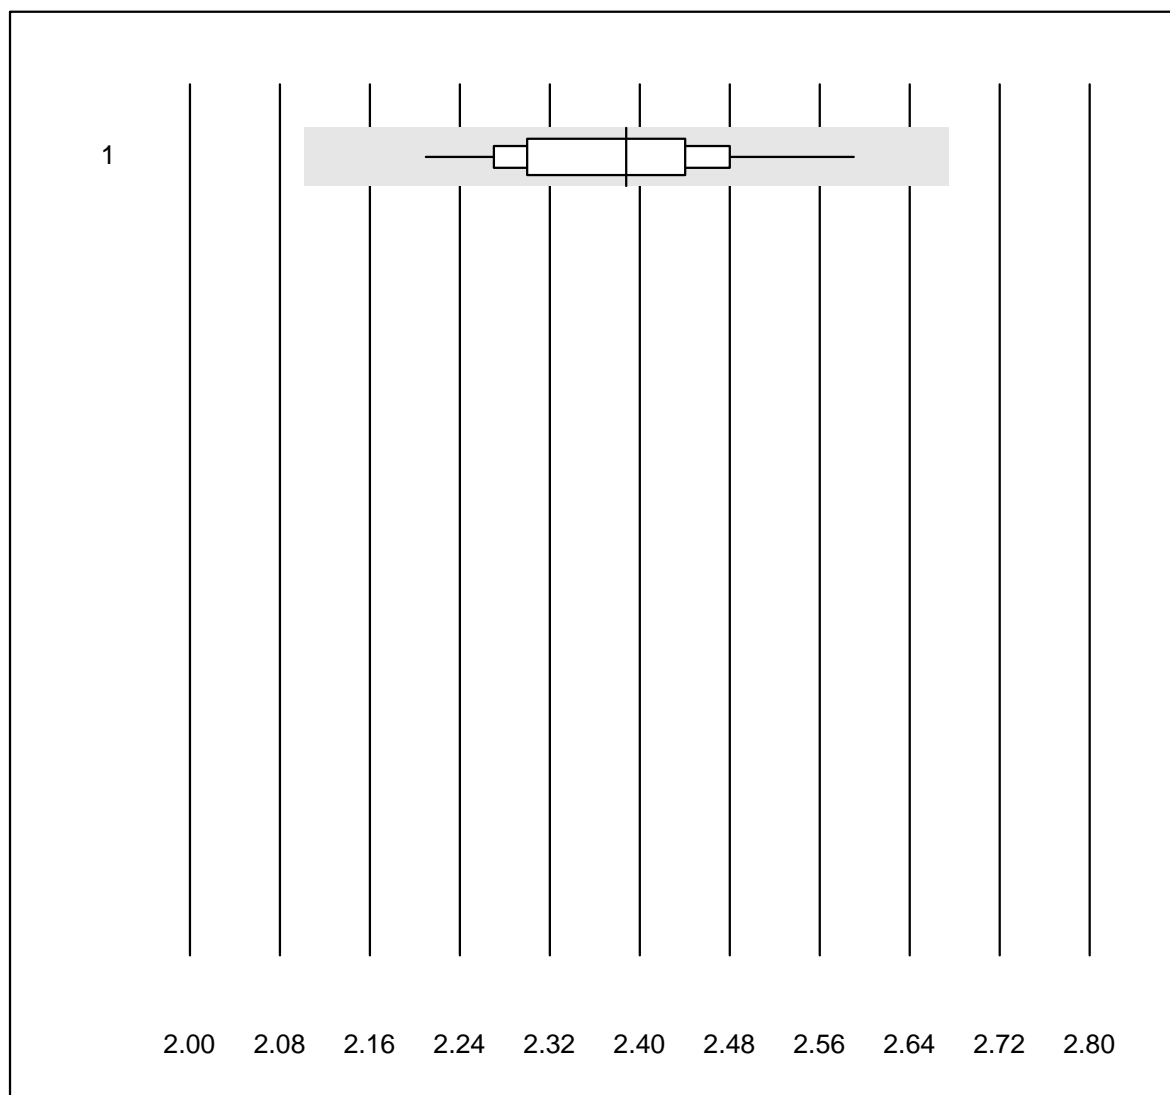


Tolérance MQ : 12 %

Calcium-urine (mmol/l)

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Chimie humide	16	93.7	0.0	6.3	2.39	4.0	e

Chlorures-urine

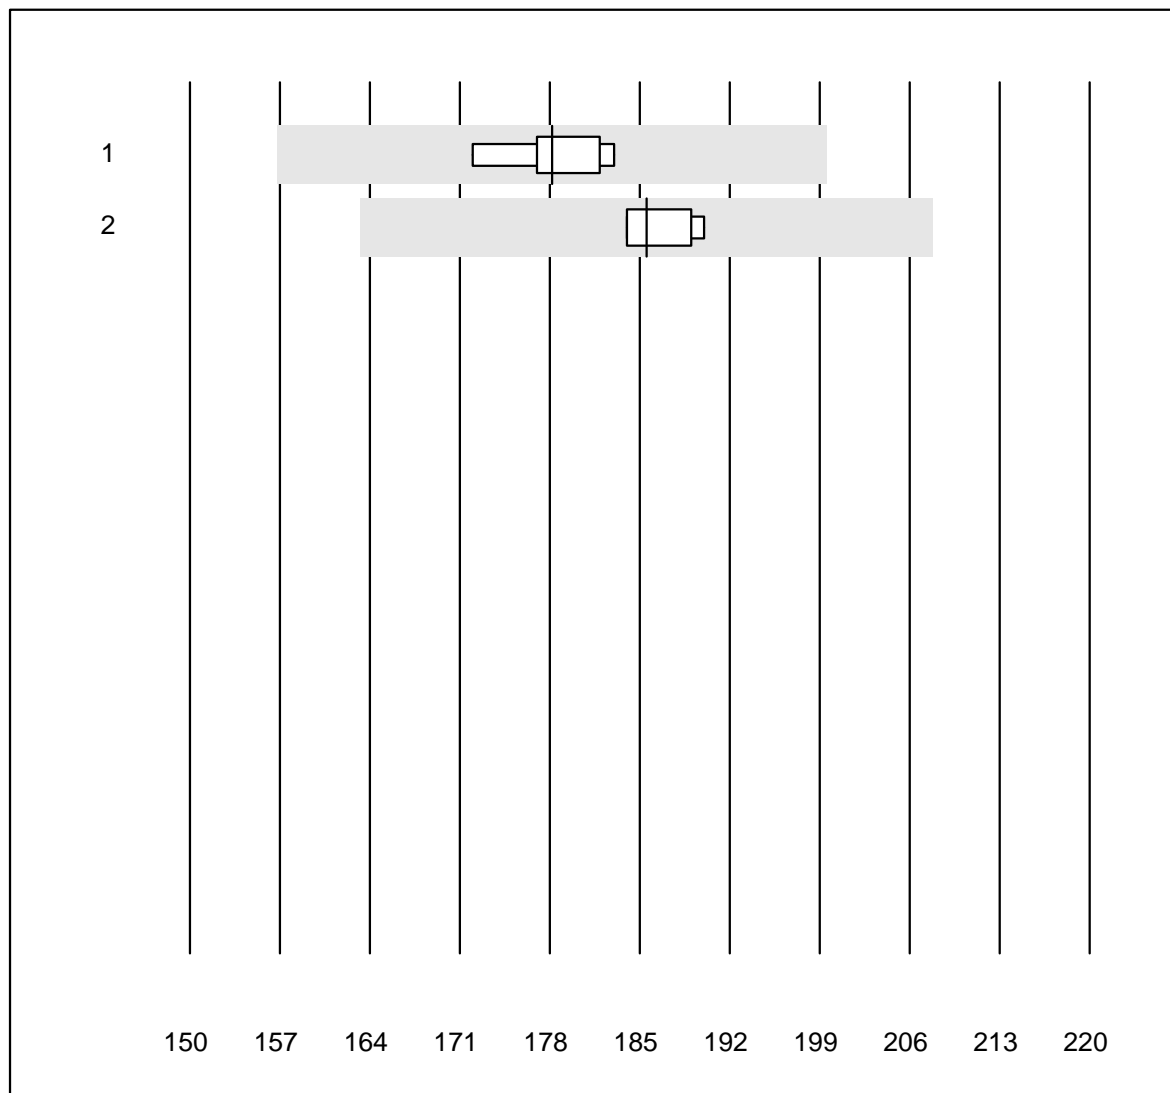


Tolérance MQ : 12 %

Chlorures-urine (mmol/l)

No. Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Cobas	7	100.0	0.0	0.0	178	2.0	e
2 Chimie humide	6	100.0	0.0	0.0	186	1.4	e

Glucose-urine

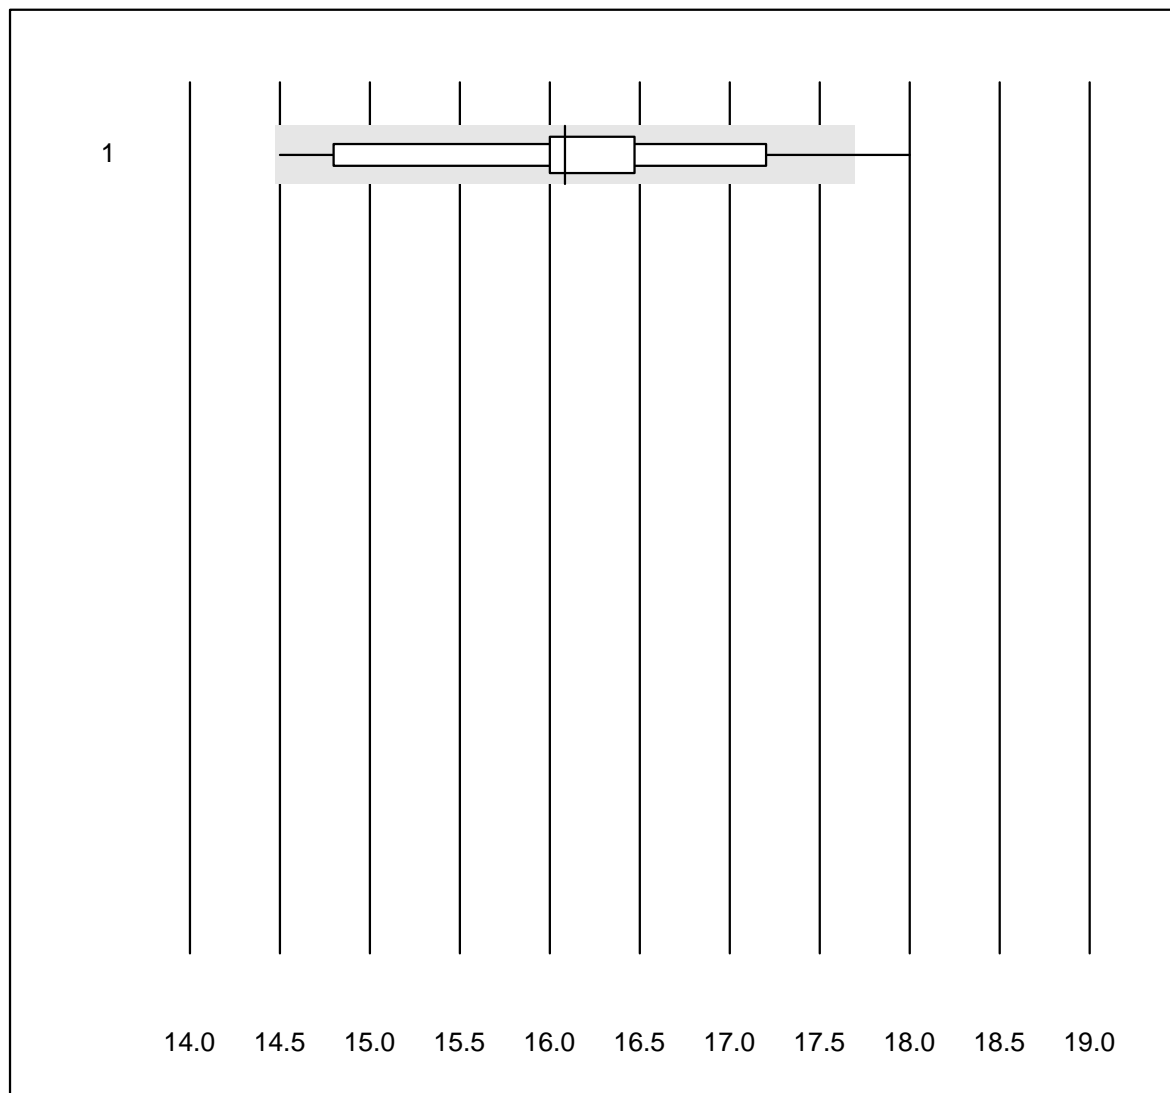


Tolérance MQ : 10 %

Glucose-urine (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	16	93.7	6.3	0.0	16.1	5.1	e*

Magnésium-urine

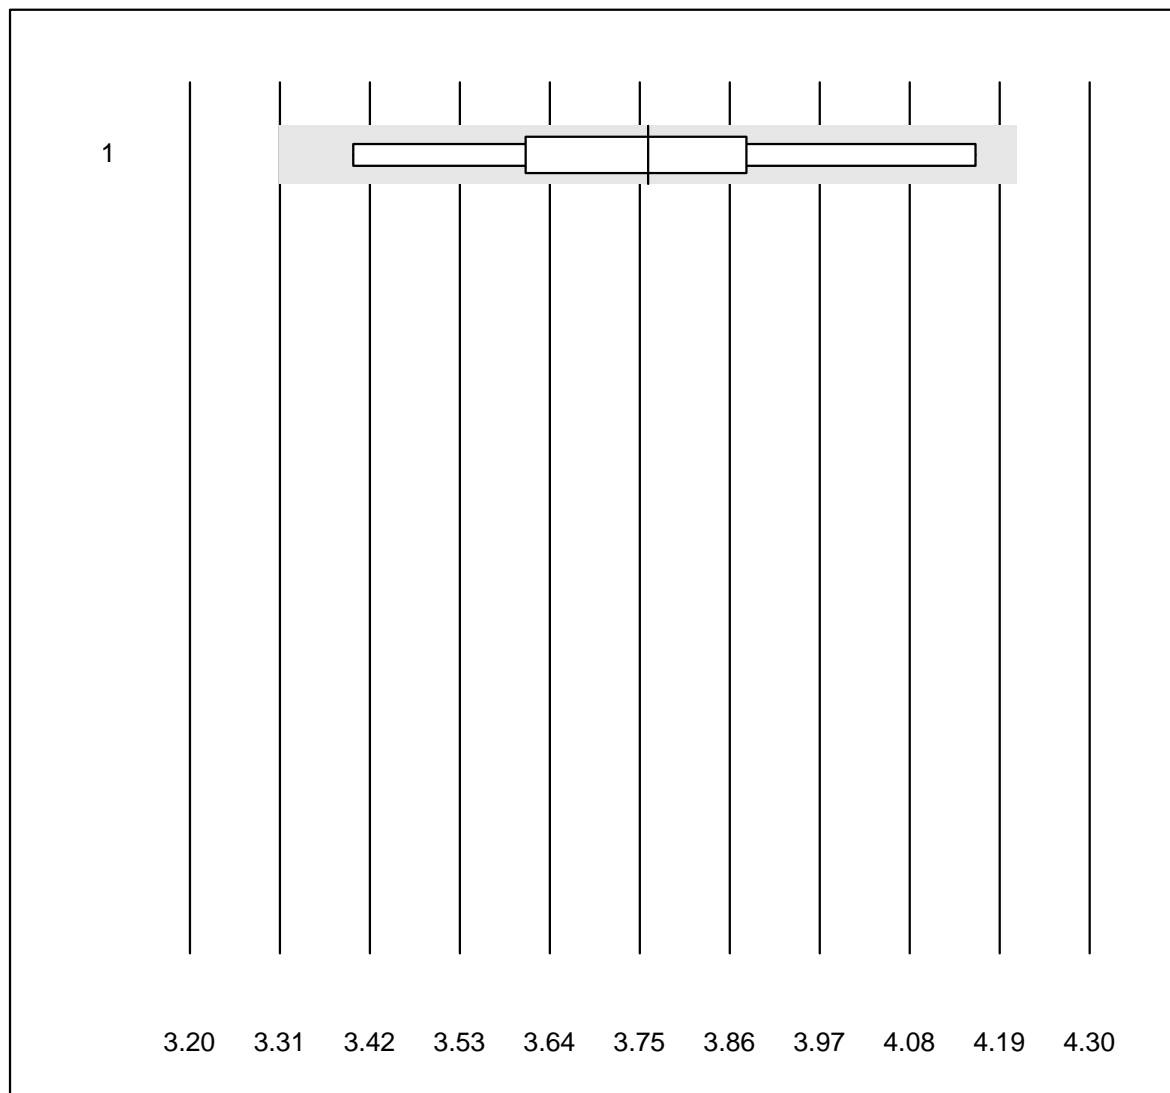


Tolérance MQ : 12 %

Magnésium-urine (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	9	100.0	0.0	0.0	3.76	6.0	e*

Osmolalité-urine

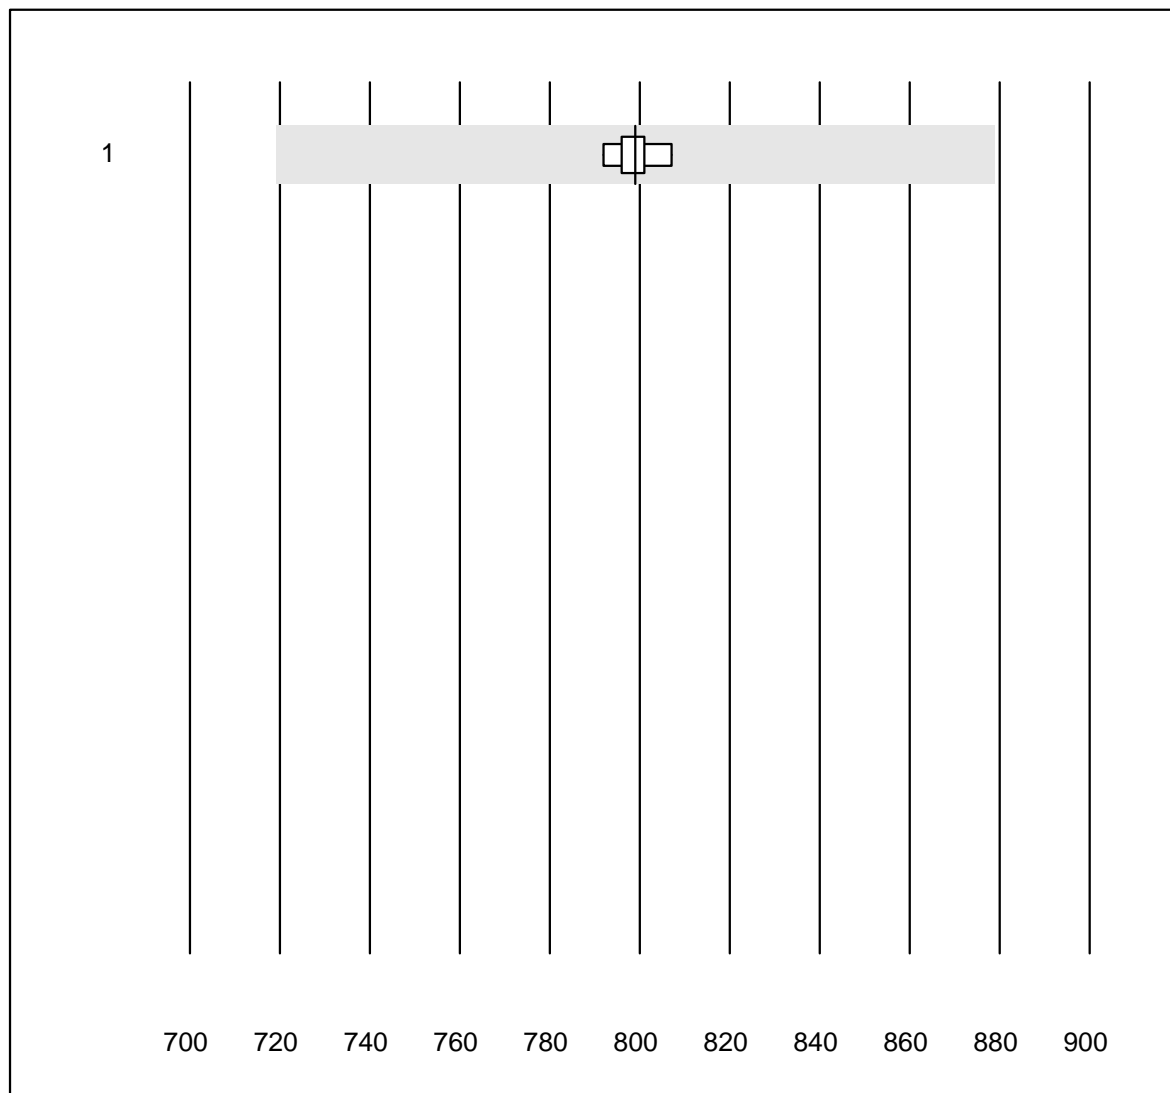


Tolérance MQ : 10 %

Osmolalité-urine (mosm/kg)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cryoscopie	9	100.0	0.0	0.0	799	0.6	e

Phosphore-urine

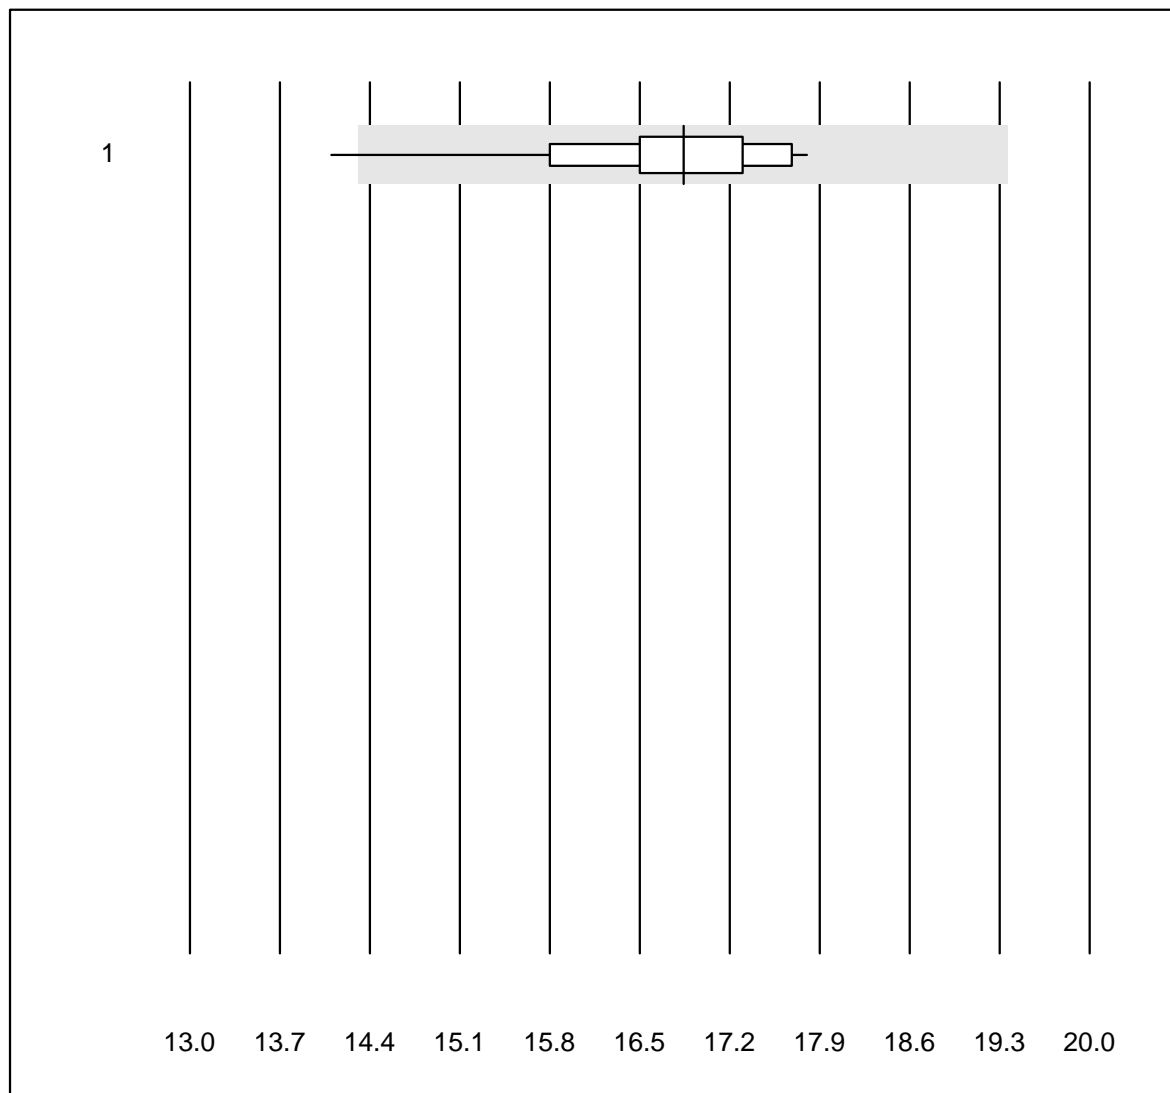


Tolérance MQ : 15 %

Phosphore-urine (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	16	93.7	6.3	0.0	16.8	5.3	e

Potassium-urine

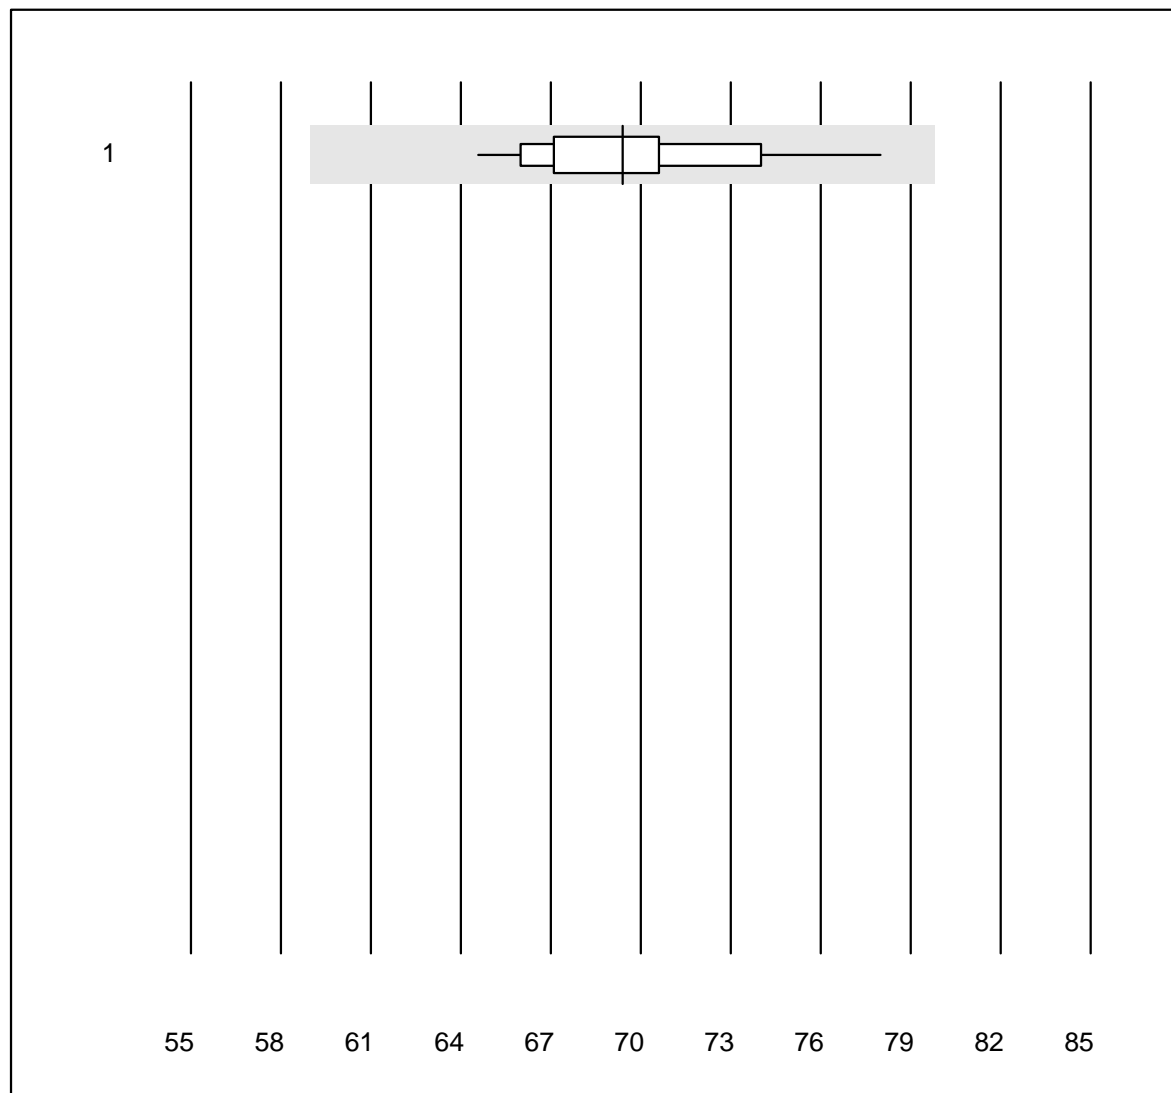


Tolérance MQ : 15 %

Potassium-urine (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	25	100.0	0.0	0.0	69	4.5	e

Protéines-urine

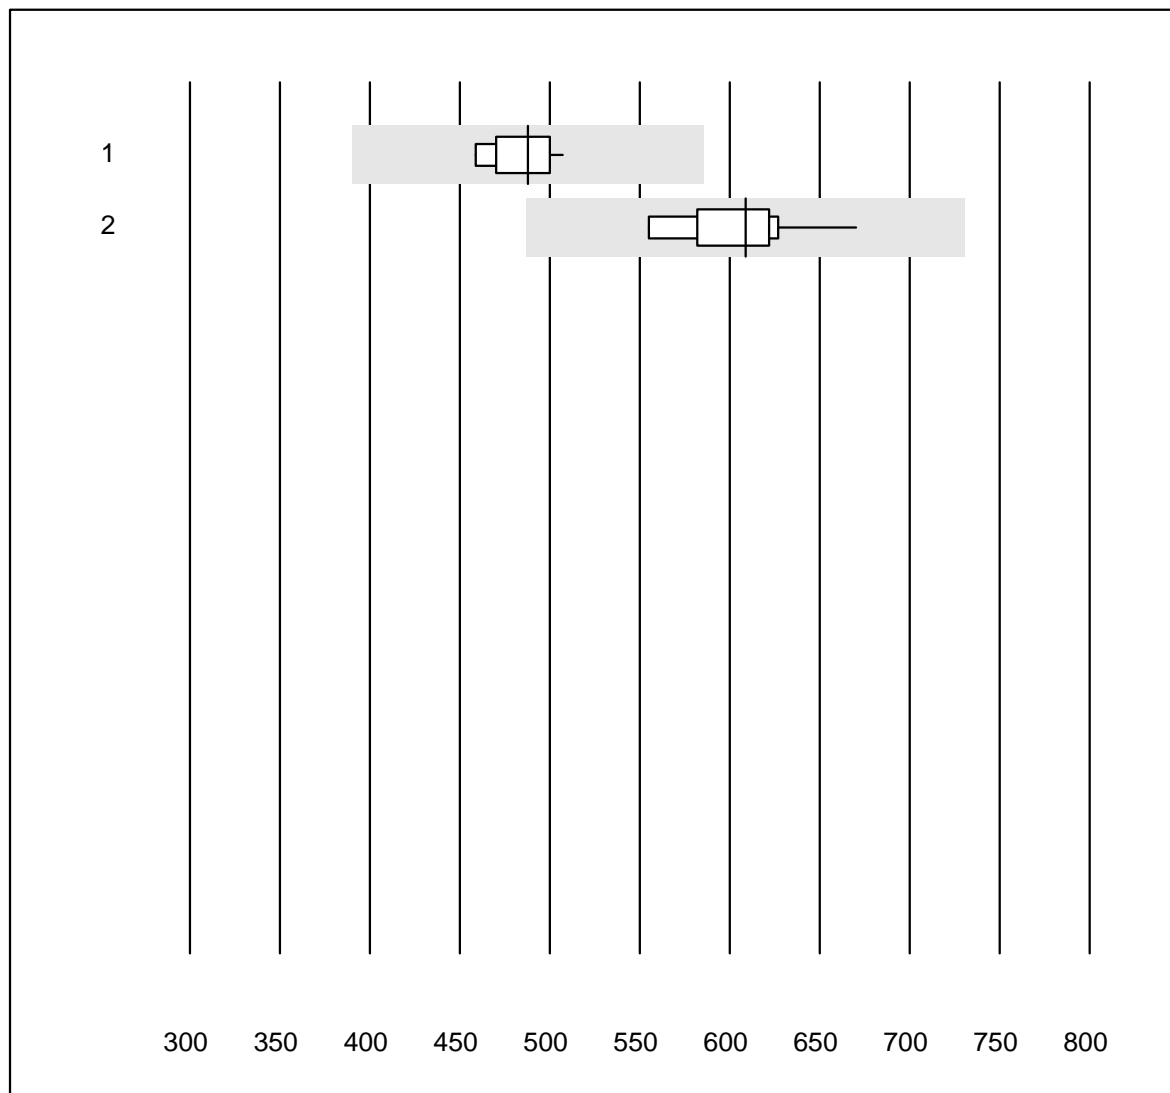


Tolérance MQ : 20 %

Protéines-urine (mg/l)


No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Cobas/Roche	10	100.0	0.0	0.0	488.0	3.3	e
2	Chimie humide	10	100.0	0.0	0.0	608.9	5.2	e

Sodium-urine

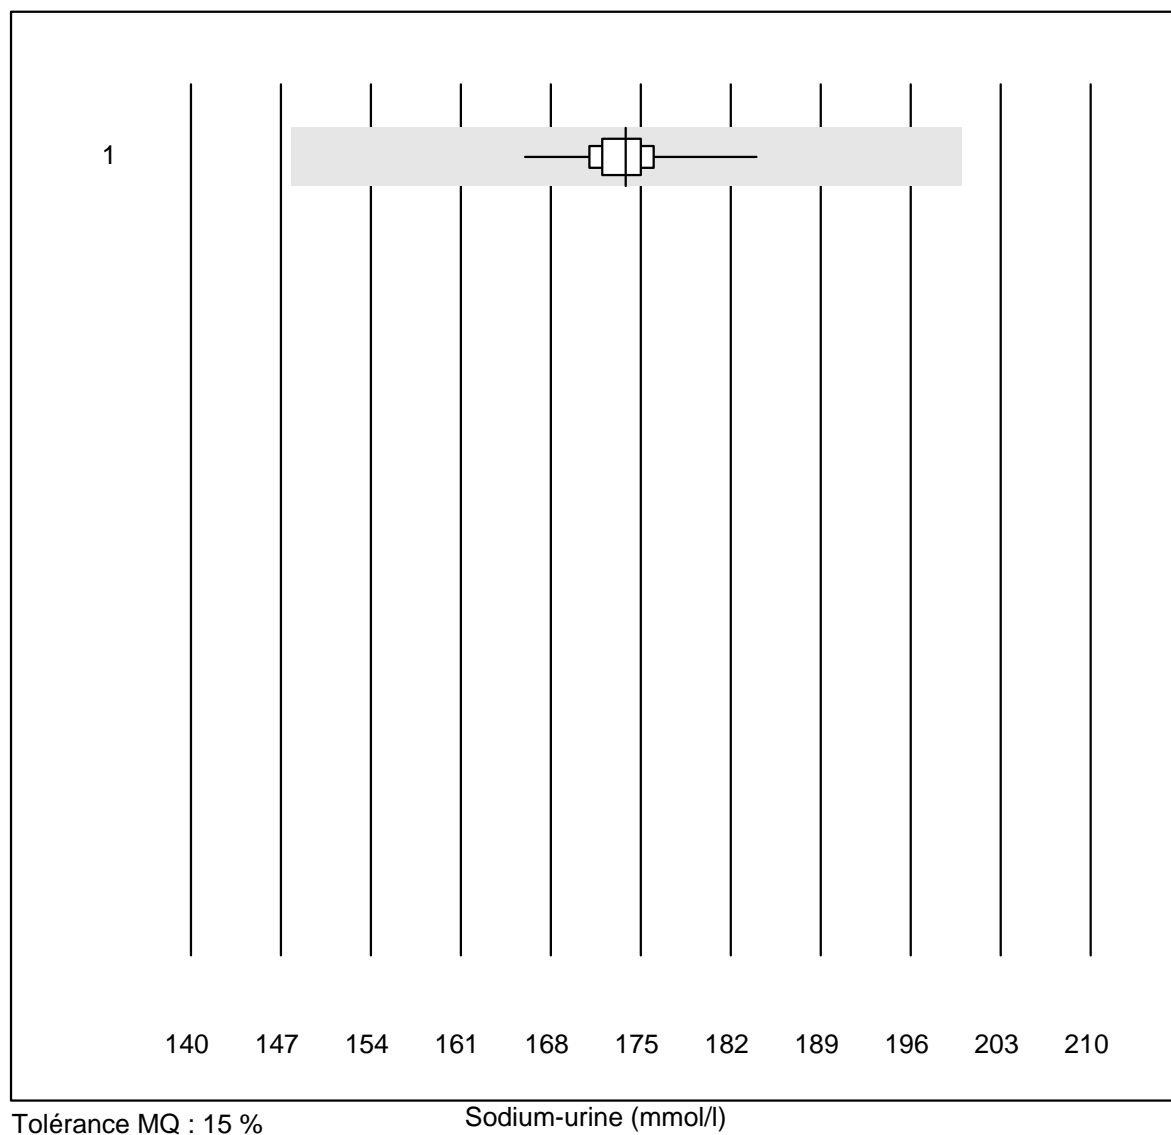

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	toutes les méthodes	25	100.0	0.0	174	2.0	e

Urée-urine

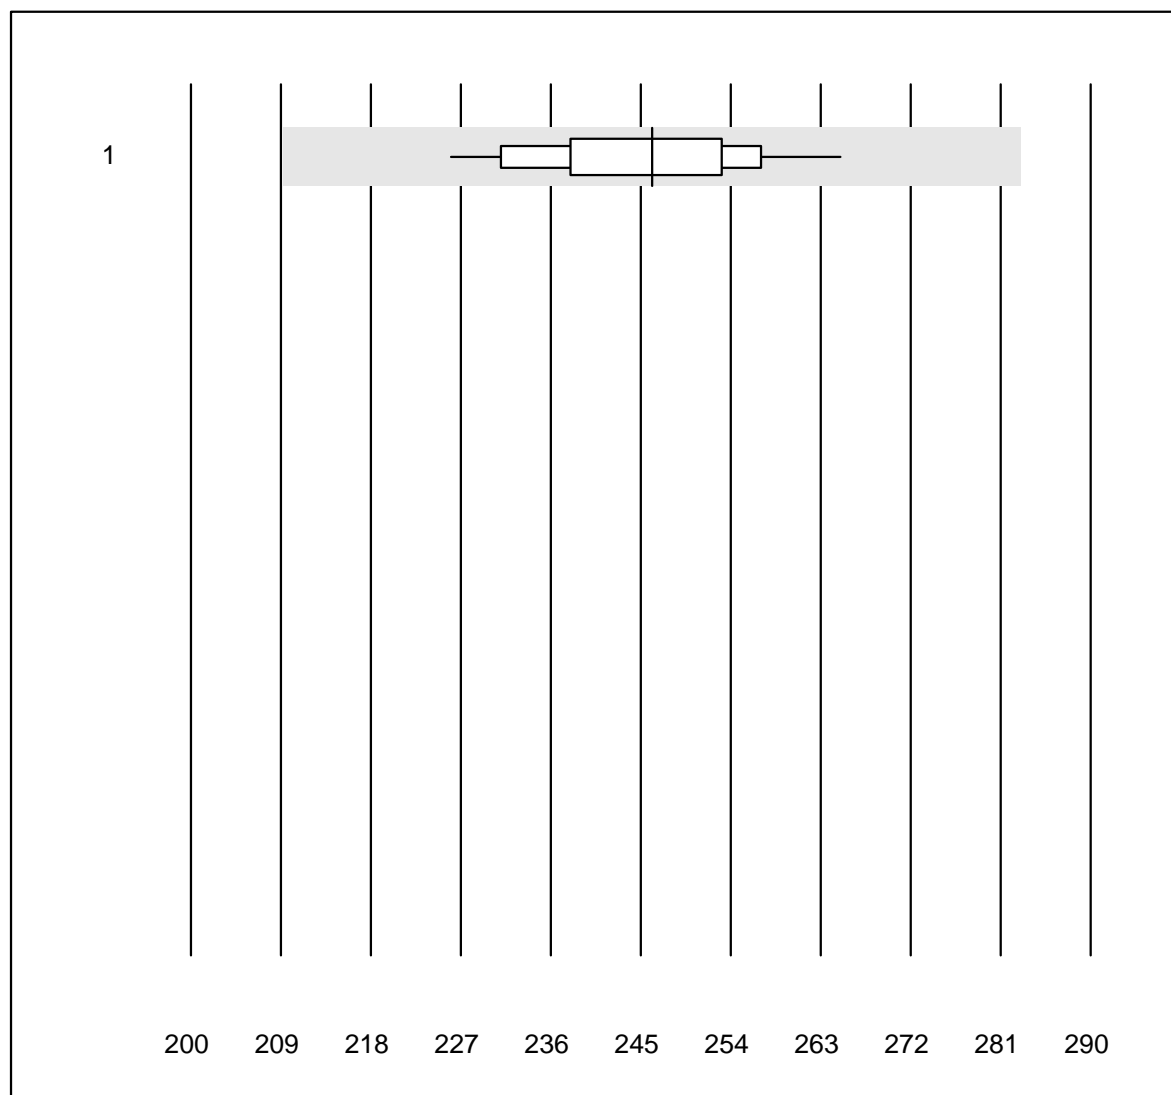


Tolérance MQ : 15 %

Urée-urine (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	Chimie humide	18	100.0	0.0	0.0	246	3.9	e

Acide urique-urine

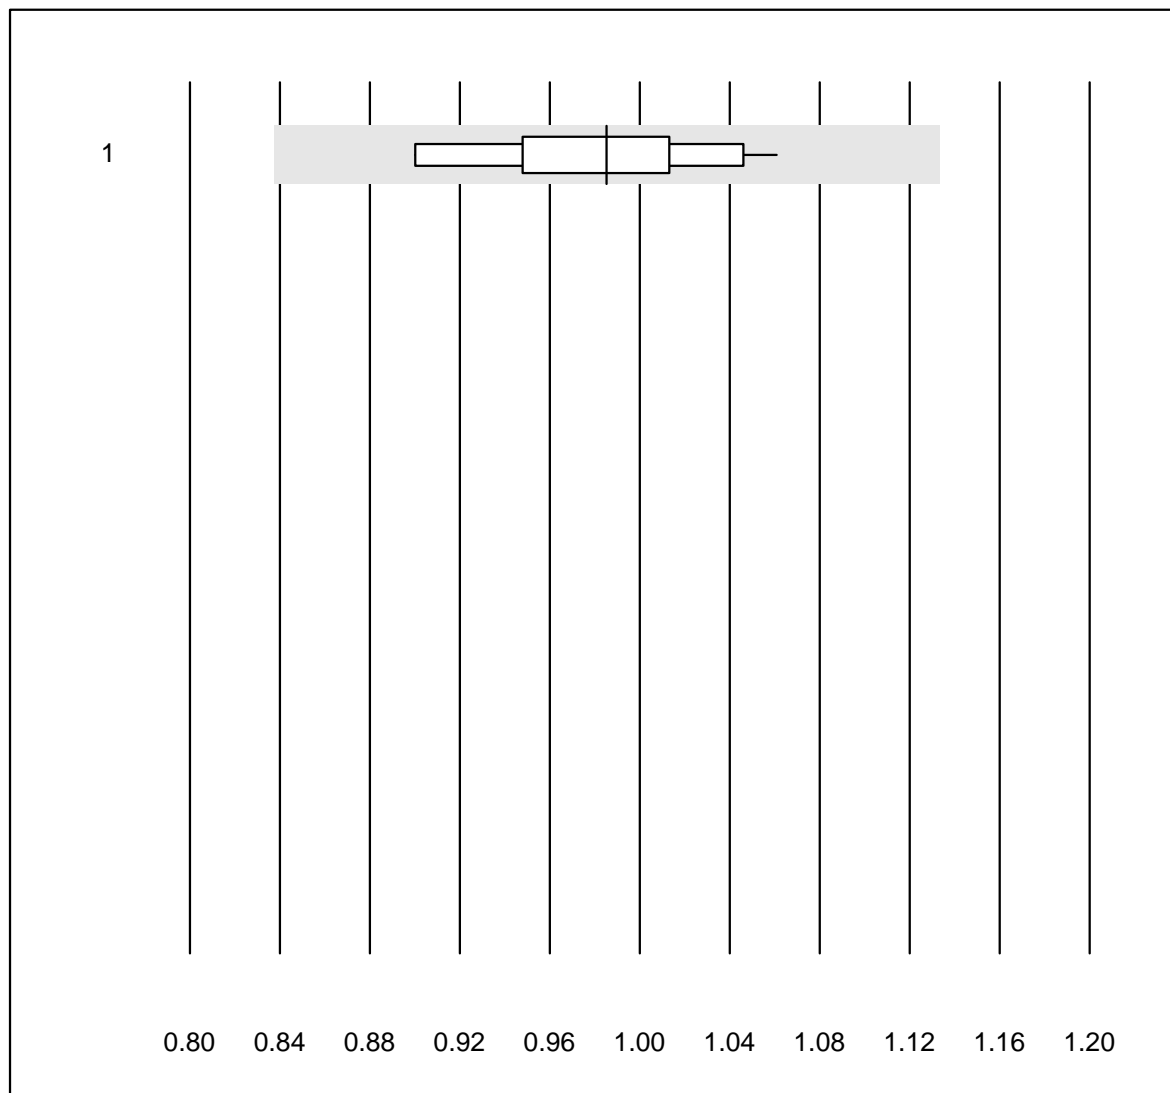


Tolérance MQ : 15 %

Acide urique-urine (mmol/l)

No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Chimie humide	16	100.0	0.0	0.0	0.99	5.1	e

Gravité spécifique-urine

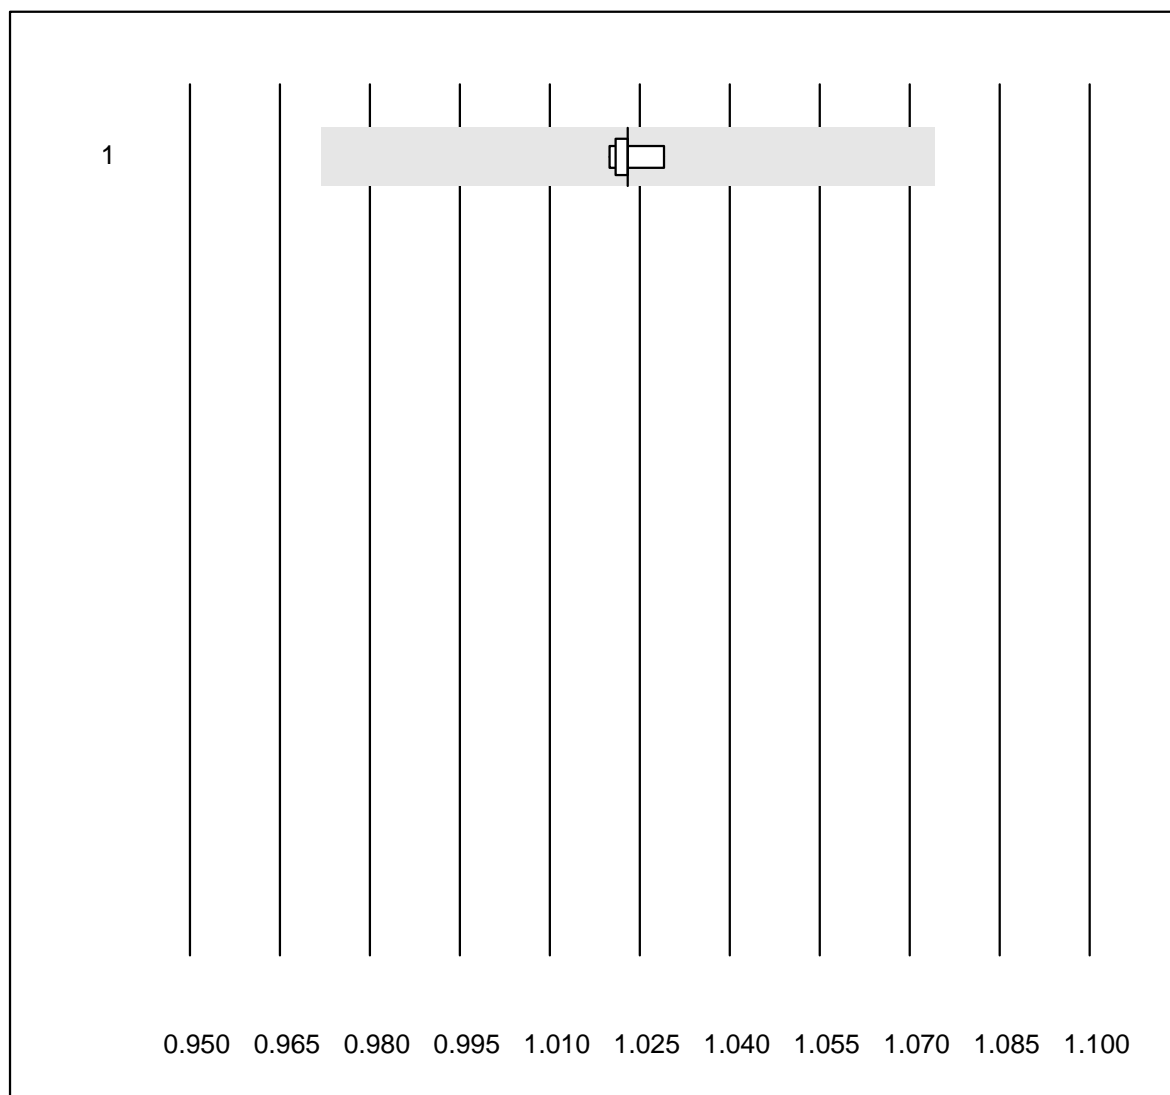


Tolérance MQ : 5 %

Gravité spécifique-urine ()


No.Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1 Refraktometer	7	100.0	0.0	0.0	1.023	0.3	e

Microalbumine

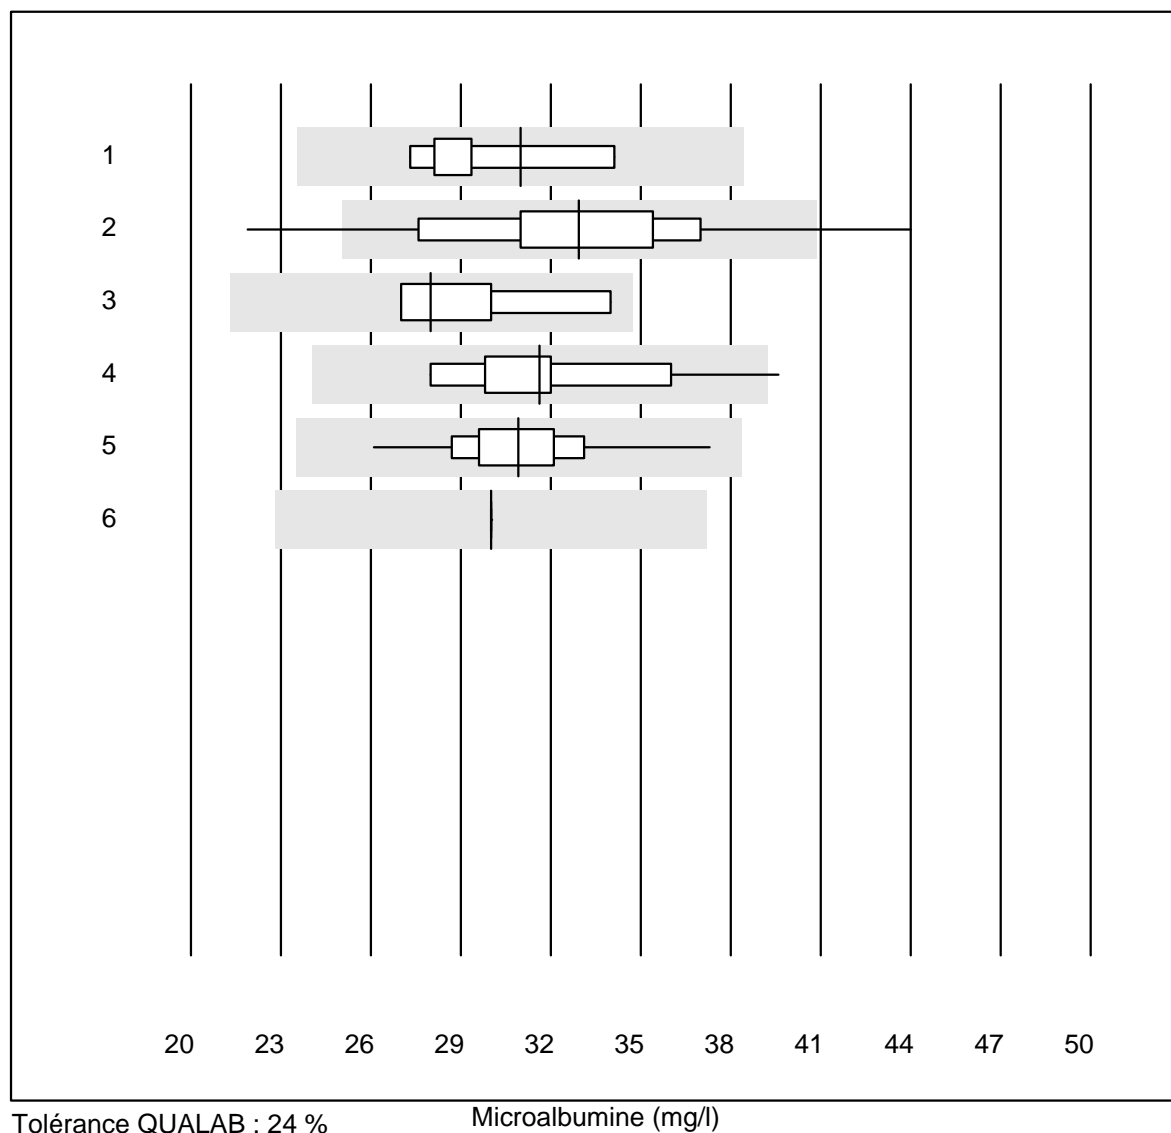

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	AFIAS	7	100.0	0.0	0.0	31.0	7.7	a
2	Afinion	402	94.6	3.2	2.2	32.9	10.8	e
3	NycoCard	9	77.8	0.0	22.2	28.0	8.3	e
4	Turbidimetrie	20	95.0	5.0	0.0	31.6	8.9	e
5	DCA2000/Vantage	130	93.1	0.0	6.9	30.9	6.0	e
6	Siemens Clinitek	10	70.0	0.0	30.0	30.0	0.0	e

Créatinine urine

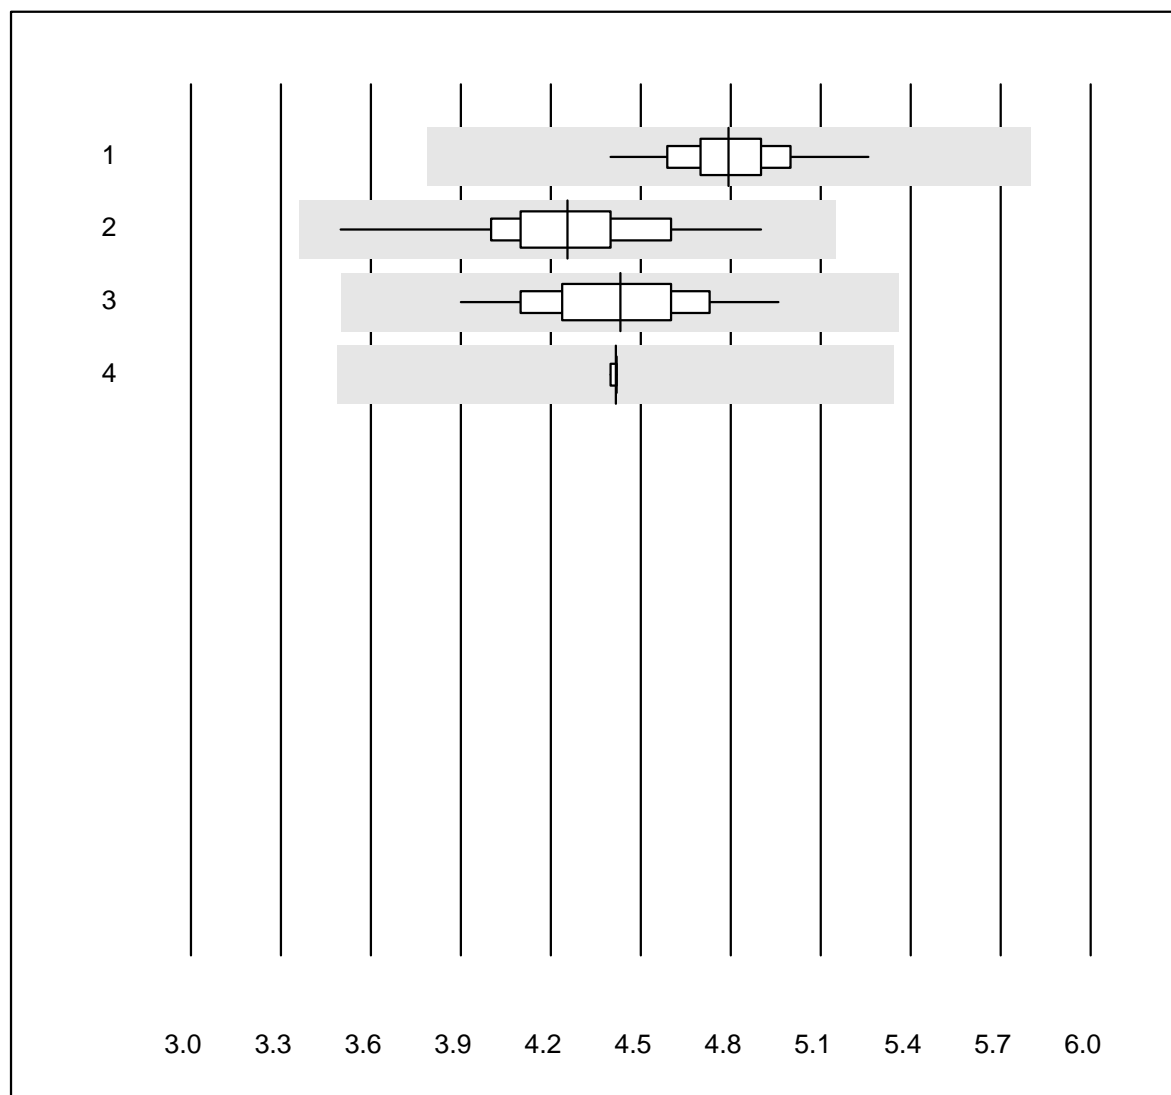

Tolérance QUALAB : 21 %

Créatinine urine (mmol/l)

No.	Méthode	Participants	% conforme	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Typ
1	DCA2000/Vantage	129	94.6	0.0	5.4	4.8	3.8	e
2	Afinion	401	98.3	0.0	1.7	4.3	5.6	e
3	Chimie humide	35	97.1	0.0	2.9	4.4	5.7	e
4	Siemens Clinitek	10	90.0	0.0	10.0	4.4	0.2	e