

Verein für
Association pour le
Associazione per il



medizinische Qualitätskontrolle
contrôle de qualité médical
controllo di qualità medico

Commentaire de l'essai interlaboratoire

2019 - 1

Échantillons de l'essai interlaboratoire

L'homogénéité et la stabilité ont été vérifiées pour tous les échantillons avant respectivement pendant l'envoi et aucune anomalie n'a été constatée. Les tests de conformité ont été réalisés par les laboratoires de l'Hôpital Universitaire de Zürich (<http://www.uzl.usz.ch/>).

Ont été produits spécifiquement pour MQ en sous-traitance les échantillons d'essai interlaboratoire suivants:

B1 Strep A Test, B2 Uricult, H4 Hématologie parasitaire, K14 Marqueur tumoral

Détermination des valeurs-cible

Pour chaque valeur-cible est indiqué le mode de détermination utilisé selon les termes de la norme ISO17043:2010, B2.1 (Colonne "Type"):

- a Valeur connue, sur la base de la production.
- b Valeur de référence certifiée lors de l'utilisation d'échantillons spécifiques
- c Valeur de référence déterminée par analyse
- d „Consensus value“ des laboratoires d'experts
- e „Consensus value“ des participants

Pour les groupes de méthode incluant plus de 9 participants, les valeurs cibles sont déterminées comme étant la „Consensus value“ ("e") des participants. Pour la détermination de ces valeurs cibles est utilisée la moyenne réalisée par le groupe de méthodes. Les résultats qui présentent un écart par rapport à la valeur cible supérieur à 1.5 fois la tolérance Qualab, sont considérés comme résultats aberrants et exclus du calcul de la valeur de référence. Les résultats des essais d'aptitude sont utilisés comme valeur de base pour éliminer les taux aberrants. Afin de mettre à disposition de tous les participants des valeurs-cible les plus pertinentes possibles, d'autres procédures peuvent également être utilisées pour des groupes de méthode plus restreints.

Incertitude dans la détermination des valeurs-cible

L'incertitude-type (u_x) est calculée à l'aide de la formule suivante (ISO13528):

$$u_x = (\text{Valeur-cible}/100) * (1.25/\text{Racine carrée du "nombre des participants"}) * \text{CV en \%}$$

- u_x est exprimée dans la même unité que la valeur-cible
- u_x peut être comparée avec l'écart-type du collectif des participants ($\text{Ecart-type} = \text{Valeur-cible} * \text{CV en \%} / 100$)
- Pour un nombre de participants >18, l'incertitude-type (u_x) est significativement plus petite que la dispersion du collectif des participants et peut donc être négligée.


Tolérances QUALAB et MQ

Pour les analyses obligatoires sont utilisées les tolérances fixées par Qualab (www.qualab.ch, contrôle de qualité externe). Pour les analyses non-obligatoires, les tolérances sont fixées par le directeur de MQ pilotant l'essai interlaboratoire.

Si l'incertitude déterminée de la valeur de référence u_x est supérieure à 15% de la tolérance QUALAB ou de MQ, la lettre qui caractérise le type de détermination de la valeur-cible est en outre marquée d'une étoile (par exemple "e*"). Nous rendons ainsi les participants attentifs au fait que l'incertitude de la valeur de référence peut avoir une influence sur l'évaluation.

Représentation graphique

La représentation graphique des résultats est la suivante:

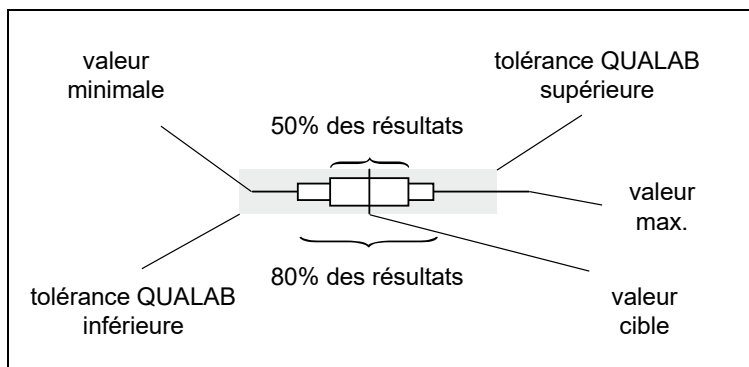


Comparaison des appareils

Les données de ce rapport vous permettent de comparer les performances respectives des divers appareils. Toutefois, vous devez tenir compte des points suivants:

- Le contrôle Chimie K1 est un sérum de contrôle commercialisé prêt à l'emploi. Même si l'échantillon est d'origine humaine, des effets matriciels sont possibles. Ceux-ci dépendent de l'appareil et peuvent générer des valeurs cible différentes.
- Seul un échantillon a été mesuré. La dispersion des résultats étant dépendante de la nature de l'échantillon (effets matriciels) et du niveau du résultat, les coefficients de variation déterminés (CV en %) ne sont pas toujours valables.
- Une grande partie des taux aberrants est due à des erreurs administratives (erreur d'unité, confusion des résultats) ou à des erreurs de manipulation (erreur d'échantillon, dissolution incorrecte, mélange insuffisant) et n'a rien à voir avec le type d'appareil.


Zürich, 6.4.2019



Dr. R. Fried
Directeur de l'essai interlaboratoire

Il n'est pas autorisé de publier une partie ou l'intégralité de ce rapport sans notre accord écrit préalable. L'original est conservé dans les archives sous www.mqzh.ch.

Quick OA

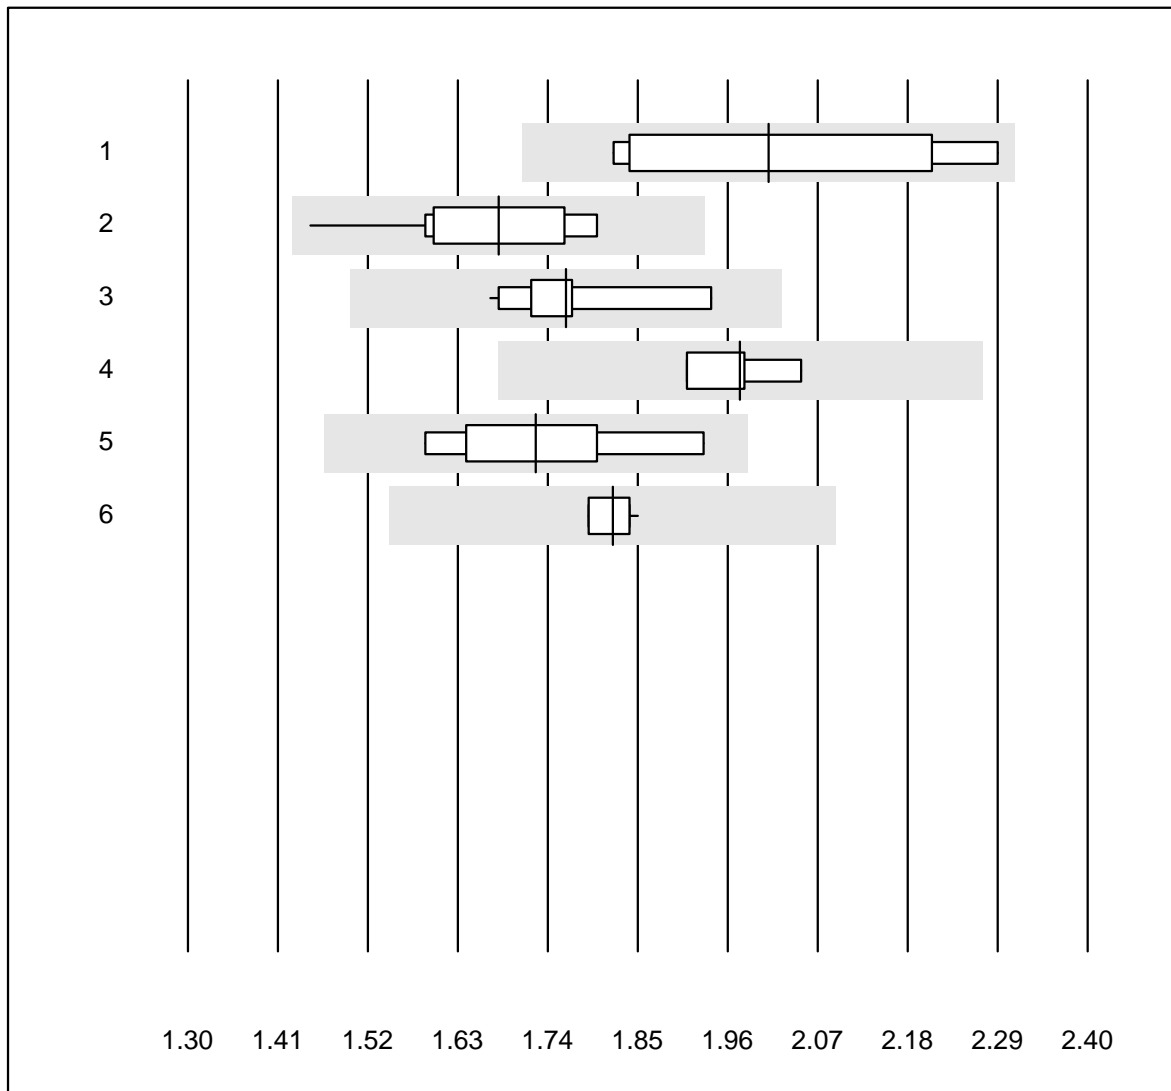


QUALAB Toleranz : 15 %

Quick OA ()


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Neoplastin Plus	7	100.0	0.0	0.0	2.01	8.9	e*
2	Innovin	12	100.0	0.0	0.0	1.68	6.1	e
3	Recombiplastin 2G	17	100.0	0.0	0.0	1.76	4.7	e
4	Eurolyser	4	100.0	0.0	0.0	1.98	2.9	e
5	Autres méthodes	6	100.0	0.0	0.0	1.73	7.0	e*
6	Neoplastin R	11	100.0	0.0	0.0	1.82	1.3	e

Fibrinogène OA

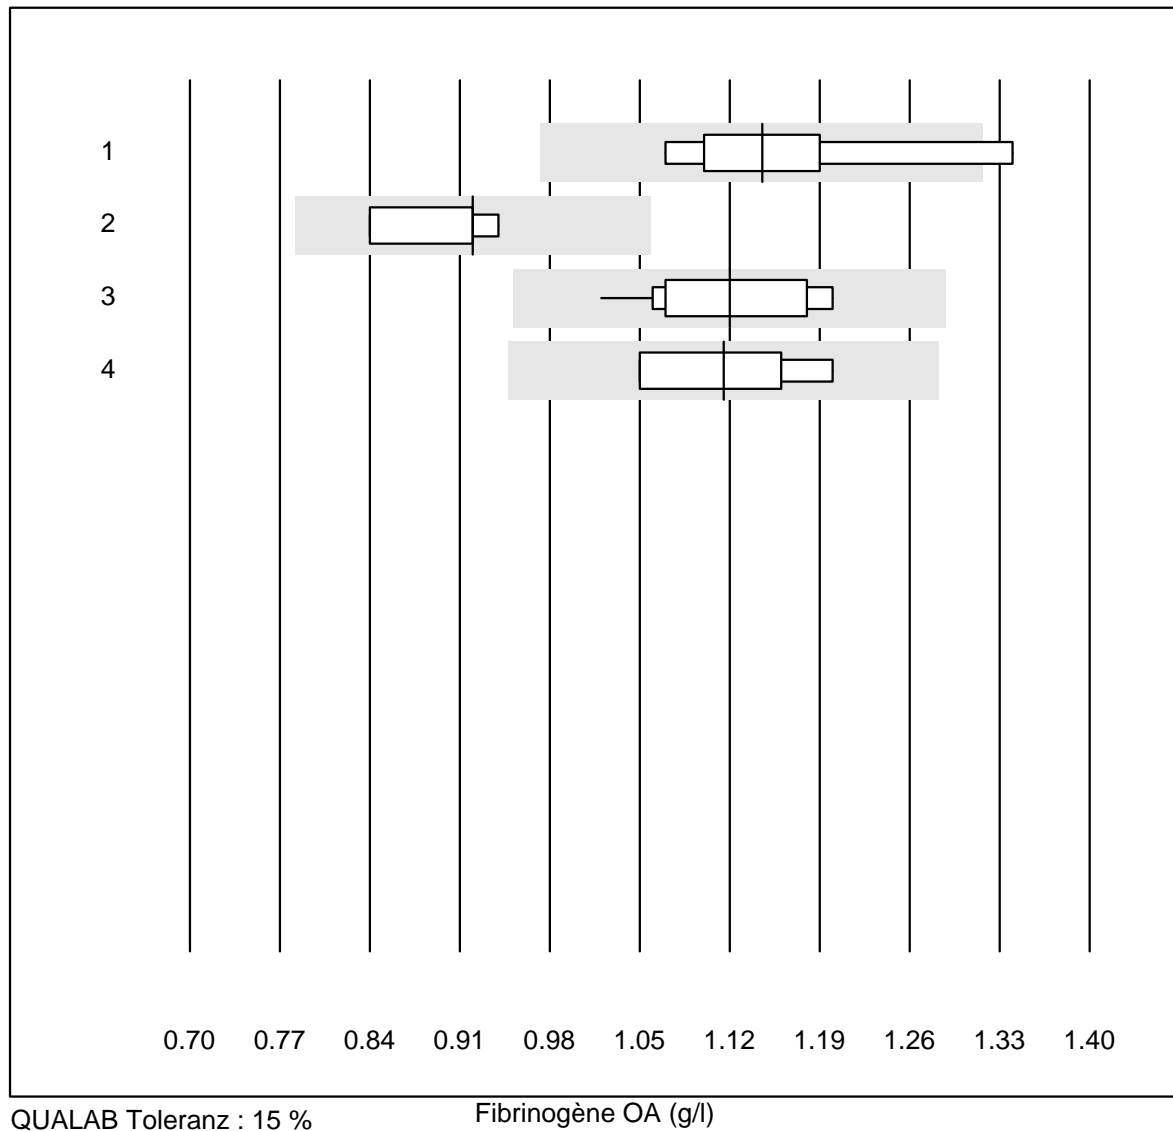


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Autres méthodes	8	87.5	12.5	0.0	1.15	7.4	e*
2	Siemens Thrombin	5	80.0	0.0	20.0	0.92	4.8	e*
3	Stago/STA	11	100.0	0.0	0.0	1.12	5.4	e
4	Fibrinogen Q.F.A.	6	100.0	0.0	0.0	1.12	5.7	e*

aPTT OA

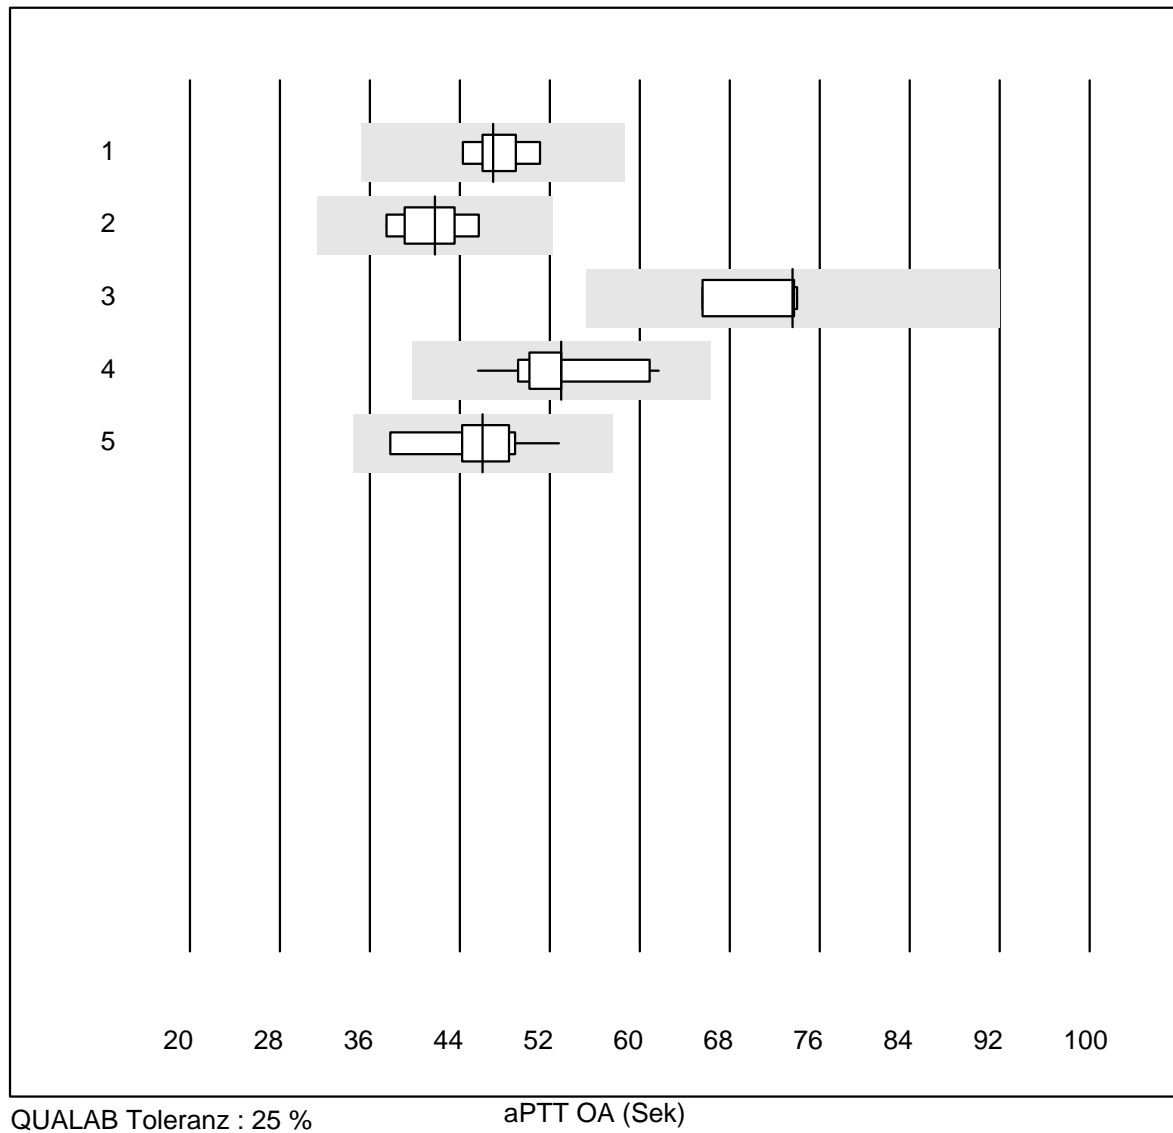

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Autres méthodes	6	100.0	0.0	0.0	47.0	5.0	e
2 Actin FS	9	100.0	0.0	0.0	41.8	7.2	e
3 Pathromtin SL	4	100.0	0.0	0.0	73.6	5.7	e
4 Stago/STA	12	100.0	0.0	0.0	53.0	8.7	e
5 aPTT-SP	10	100.0	0.0	0.0	46.1	9.2	e

INR CoaguChek

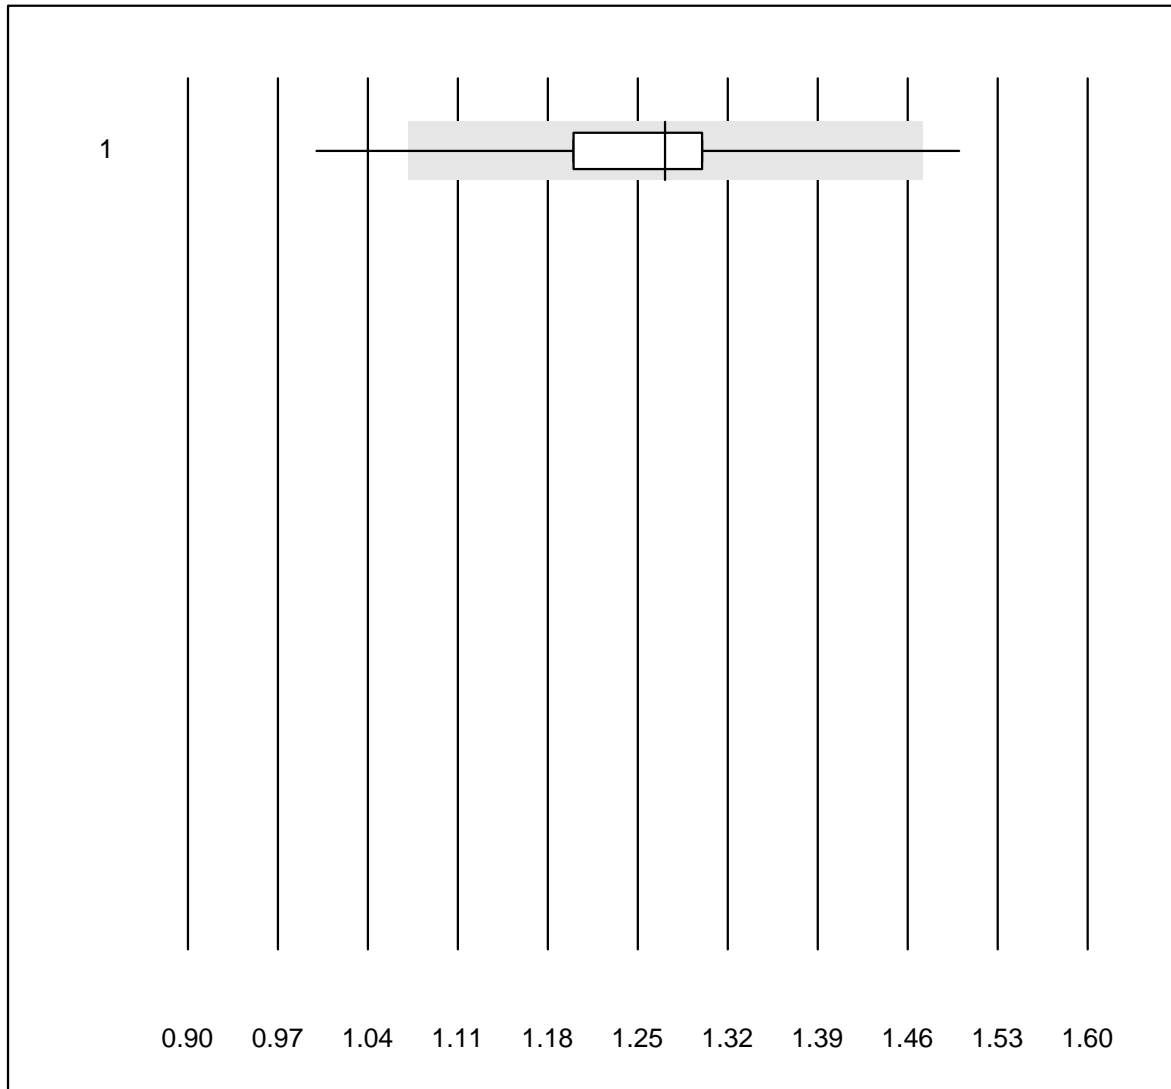


QUALAB Toleranz : 15 %
(< 1.3: +/- 0.2)

INR CoaguChek ()


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	CoaguChek Pro II	401	98.5	0.5	1.0	1.3	4.0	e

Quick N

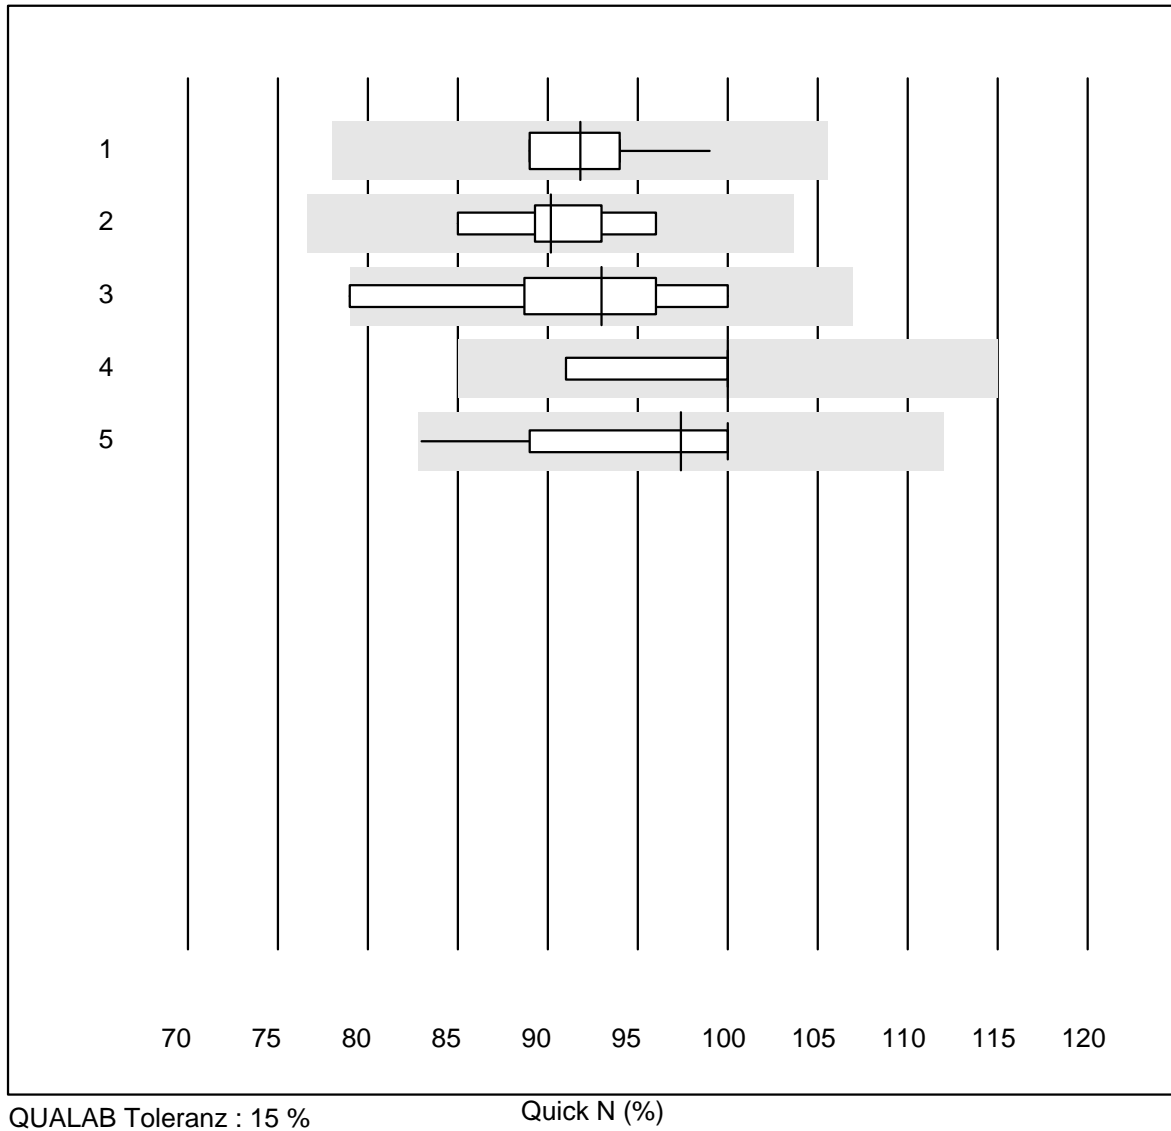


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Neoplastin R	11	100.0	0.0	0.0	92	3.4	e
2 Neoplastin Plus	6	83.3	0.0	16.7	90	4.5	e*
3 Innovin	9	88.9	11.1	0.0	93	6.8	e*
4 toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	100	3.4	e
5 Recombiplastin 2G	15	100.0	0.0	0.0	97	5.7	e

Fibrinogen N

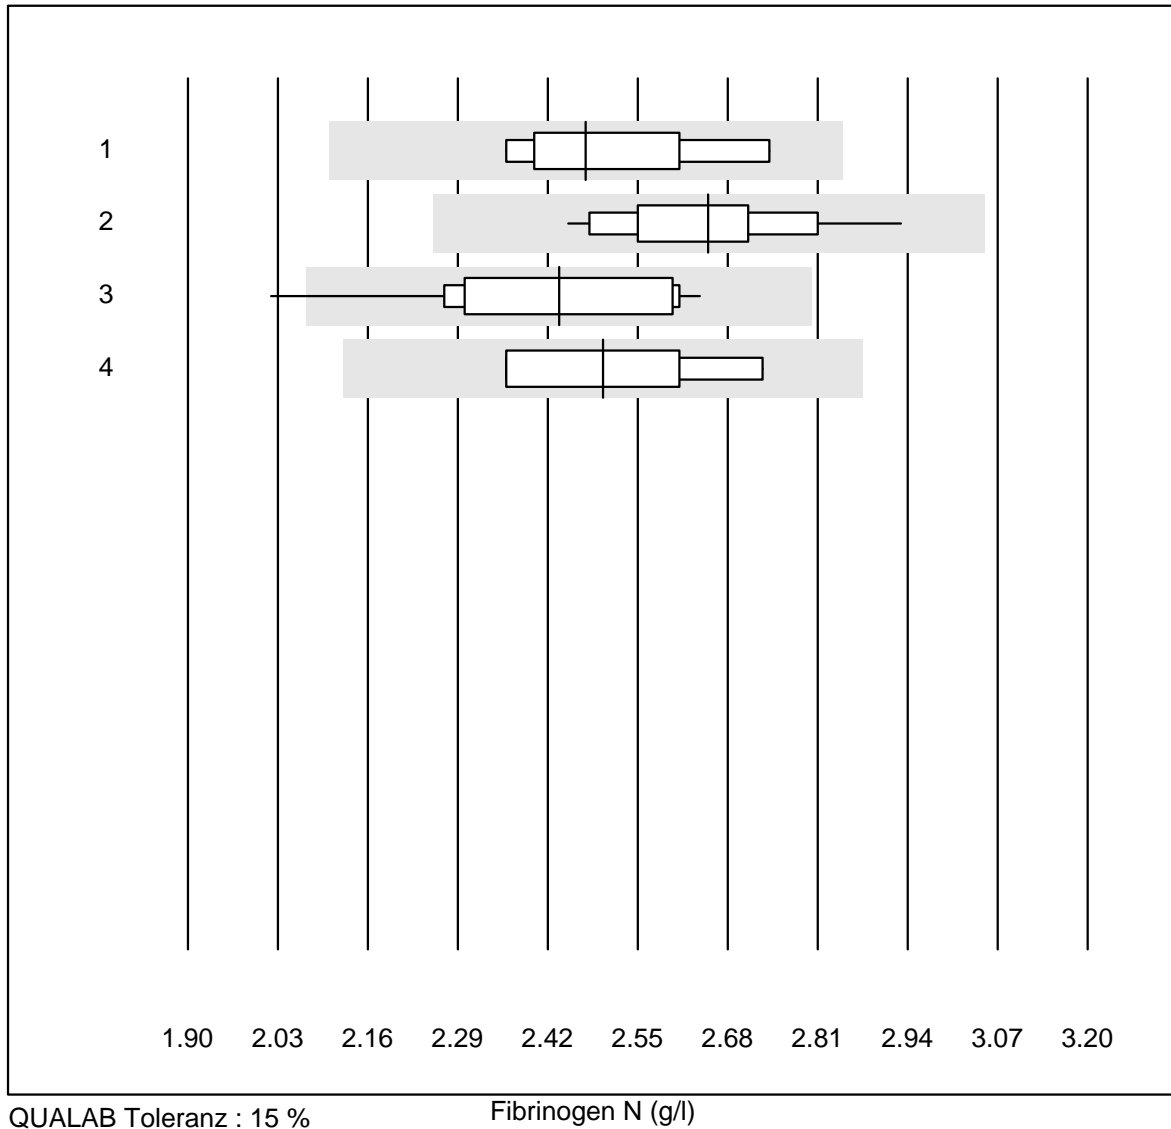


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Siemens Thrombin	8	87.5	0.0	12.5	2.48	5.4	e*
2	Stago/STA	14	100.0	0.0	0.0	2.65	4.9	e
3	Fibrinogen Q.F.A.	11	90.9	9.1	0.0	2.44	7.6	e*
4	Fib Clauss (IL)	4	100.0	0.0	0.0	2.50	7.0	e*

aPTT N

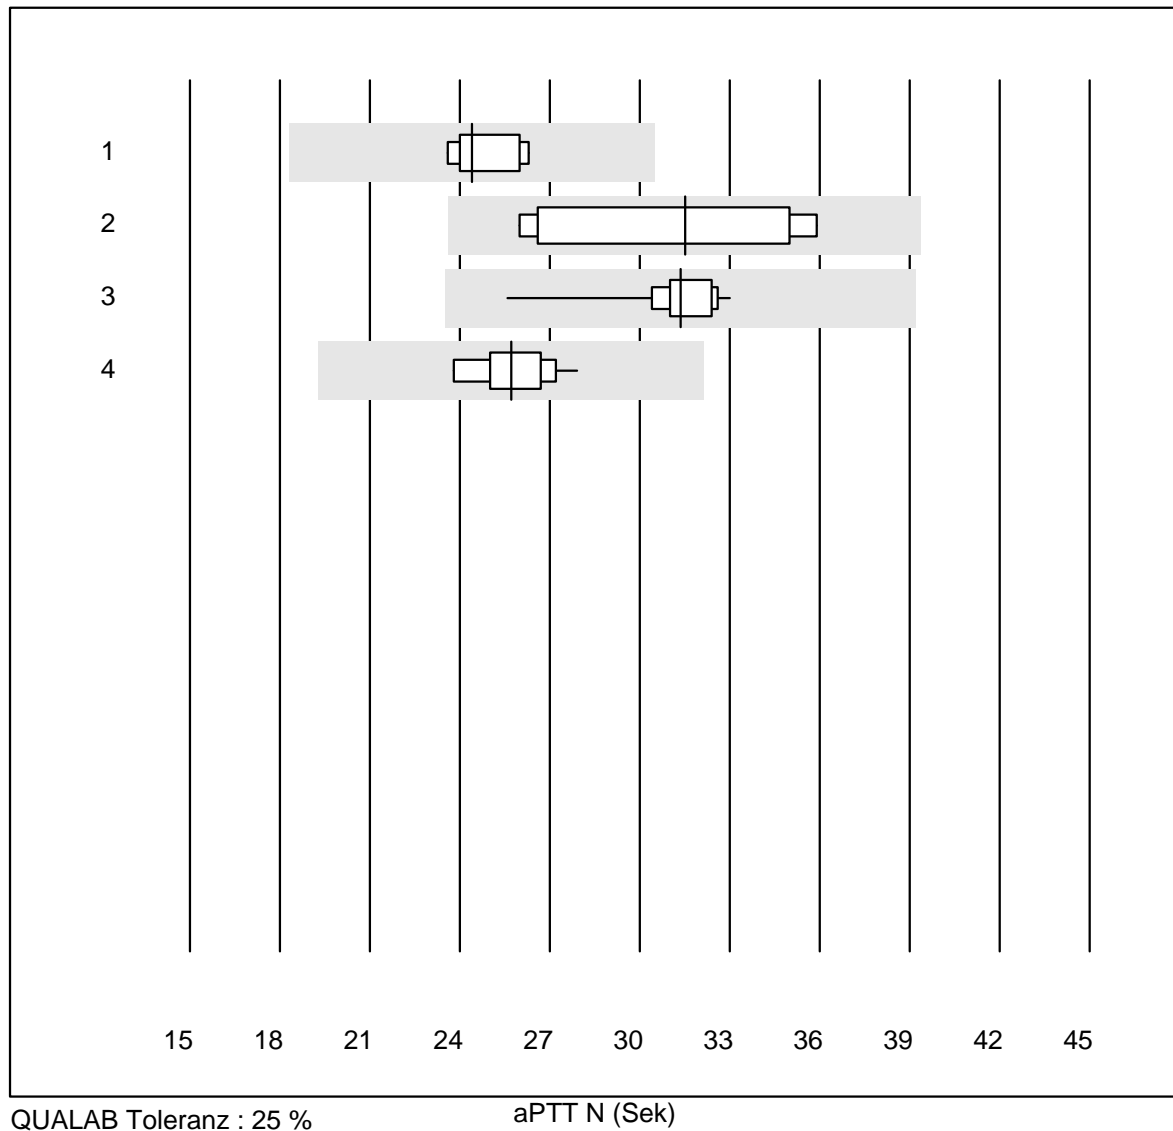

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Actin FS	5	100.0	0.0	0.0	24.4	4.9	e
2 Autres méthodes	7	100.0	0.0	0.0	31.5	14.0	e*
3 Stago/STA	14	100.0	0.0	0.0	31.4	5.8	e
4 aPTT-SP	15	100.0	0.0	0.0	25.7	4.8	e

Quick H

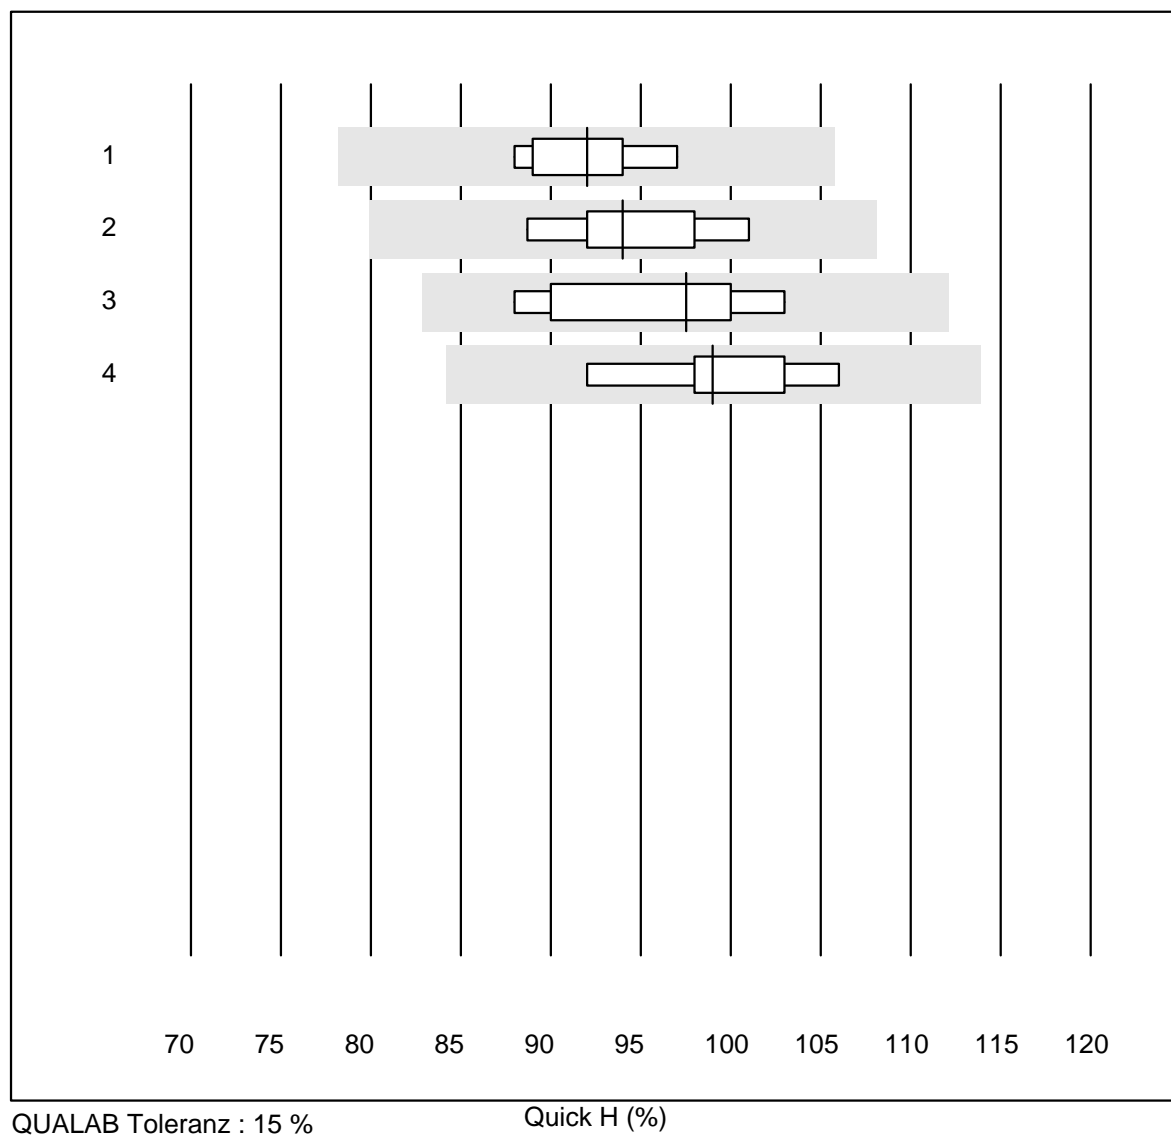


QUALAB Toleranz : 15 %

Quick H (%)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Neoplastin R	9	100.0	0.0	0.0	92	3.5	e
2	Innovin	5	100.0	0.0	0.0	94	5.1	e*
3	toutes les méthodes	8	100.0	0.0	0.0	98	5.4	e*
4	Recombiplastin 2G	7	100.0	0.0	0.0	99	4.5	e

Fibrinogen H

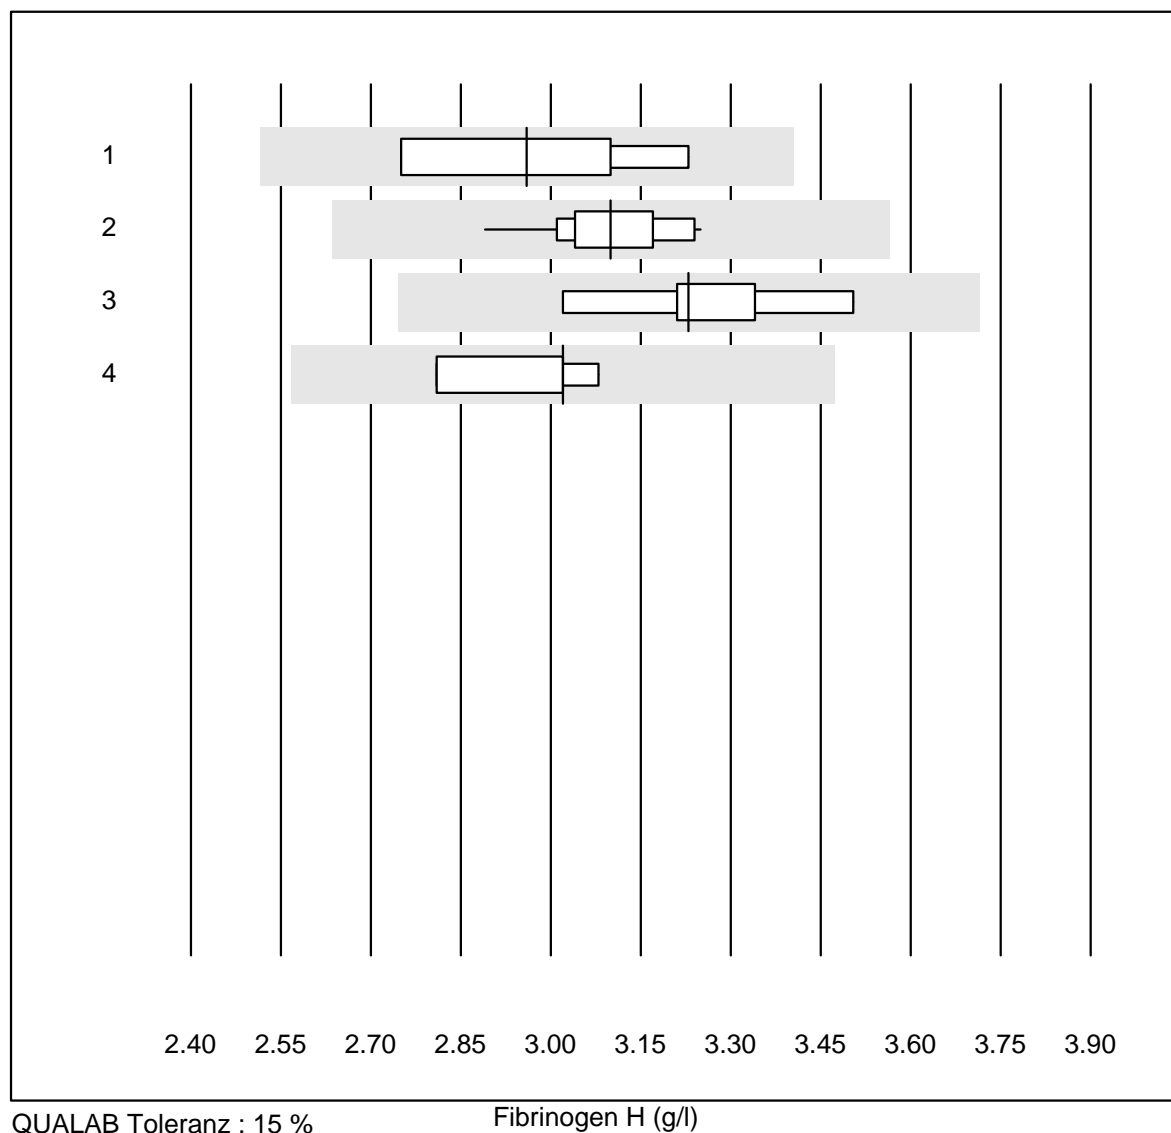

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Siemens Thrombin	5	80.0	0.0	20.0	2.96	6.8	e*
2 Stago/STA	11	100.0	0.0	0.0	3.10	3.4	e
3 Fibrinogen Q.F.A.	5	100.0	0.0	0.0	3.23	5.5	e*
4 Fib Clauss (IL)	4	100.0	0.0	0.0	3.02	4.0	e*

aPTT H

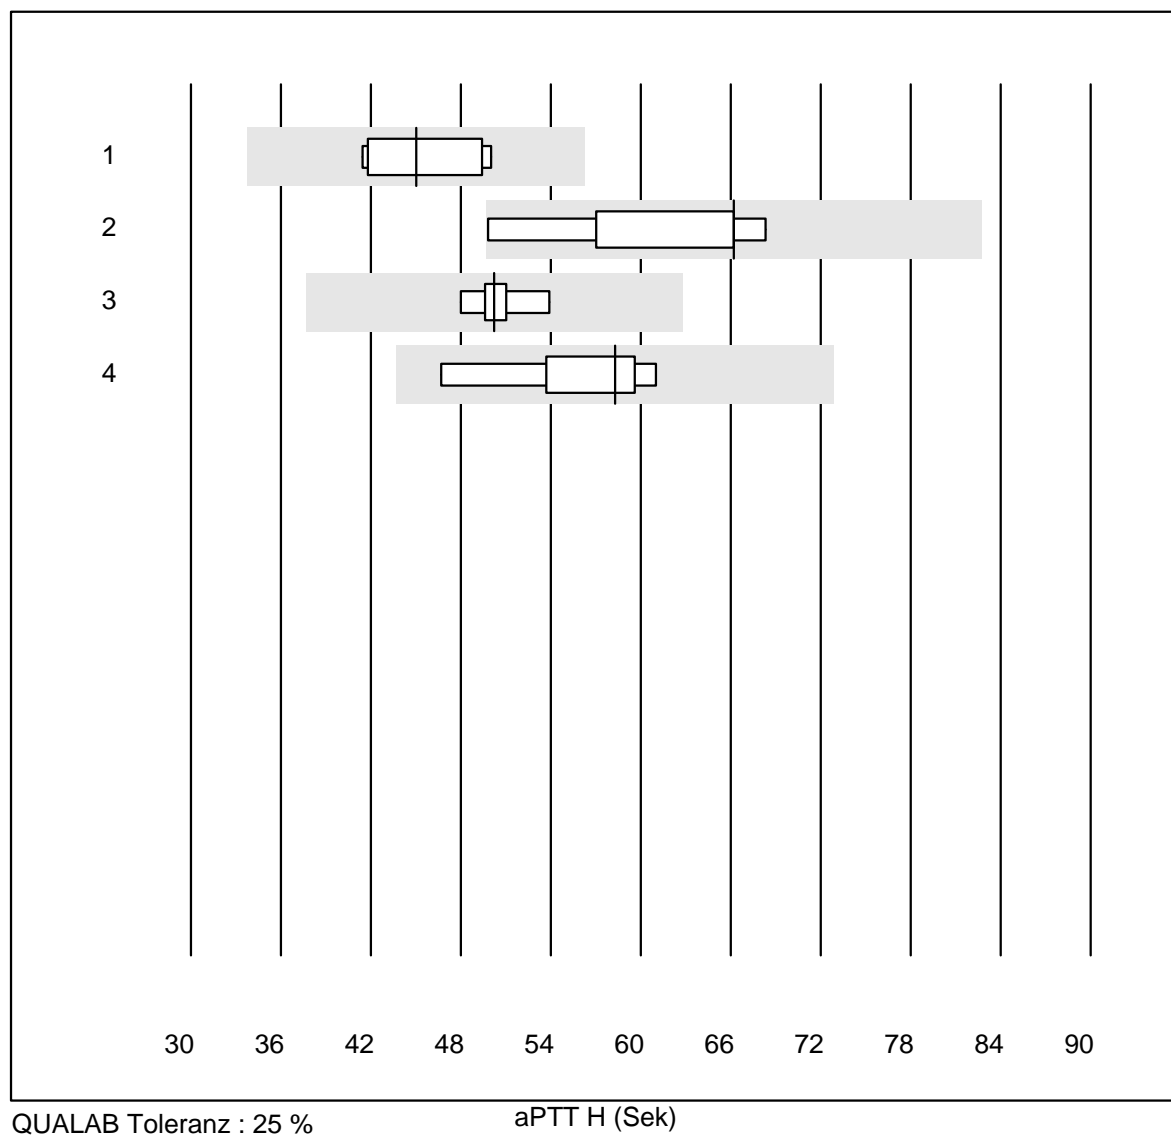


QUALAB Toleranz : 25 %

aPTT H (Sek)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Actin FS	7	100.0	0.0	0.0	45.0	7.8	e
2	Autres méthodes	5	100.0	0.0	0.0	66.2	12.8	e*
3	Stago/STA	7	100.0	0.0	0.0	50.2	3.5	e
4	aPTT-SP	5	100.0	0.0	0.0	58.3	10.4	e*

D-Dimères NC

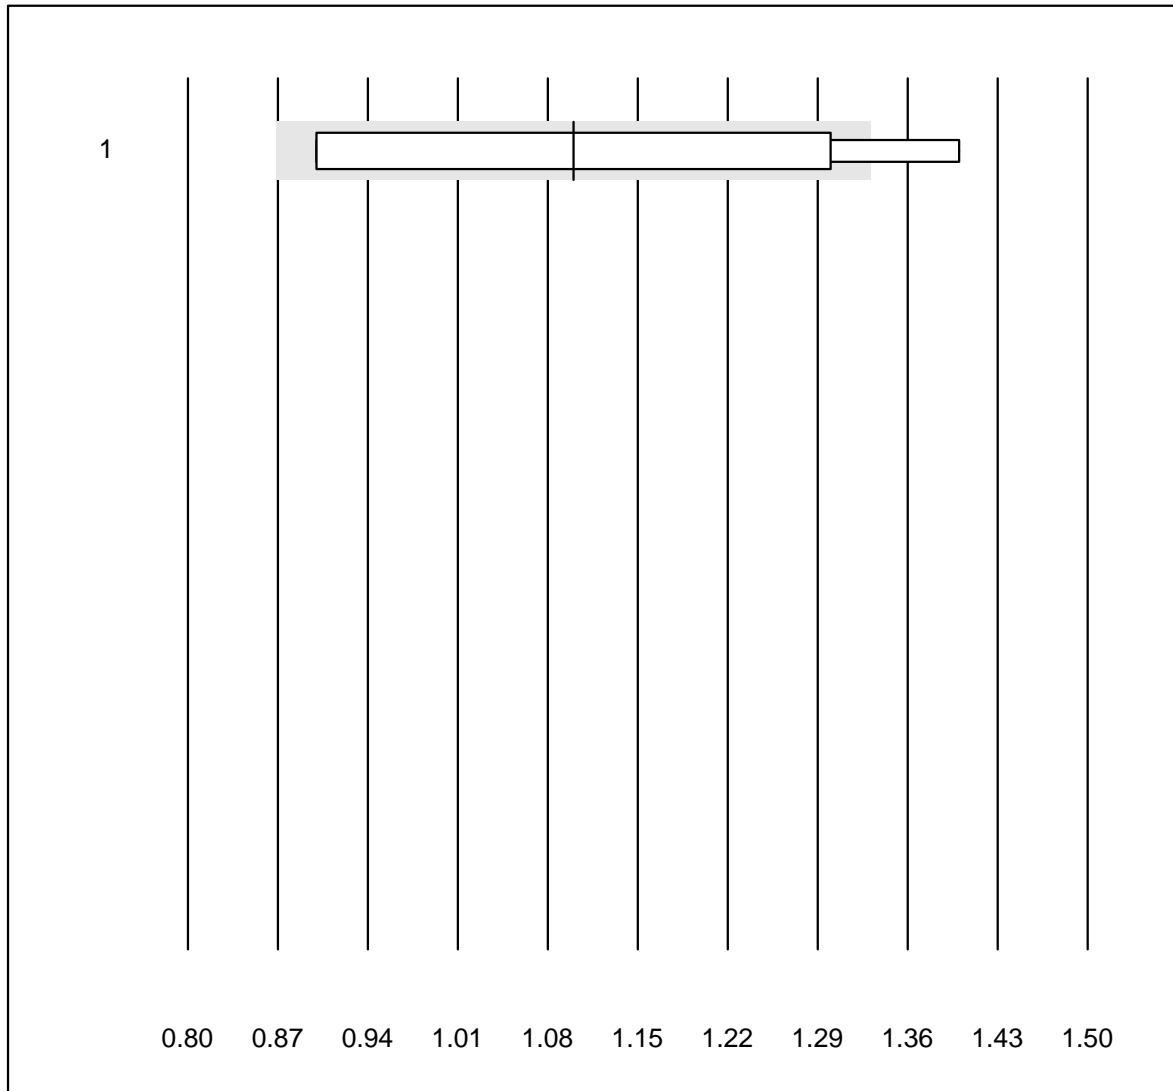


QUALAB Toleranz : 21 %

D-Dimères NC (mg/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	NycoCard	10	70.0	10.0	20.0	1.10	16.8	e*

D-Dimères

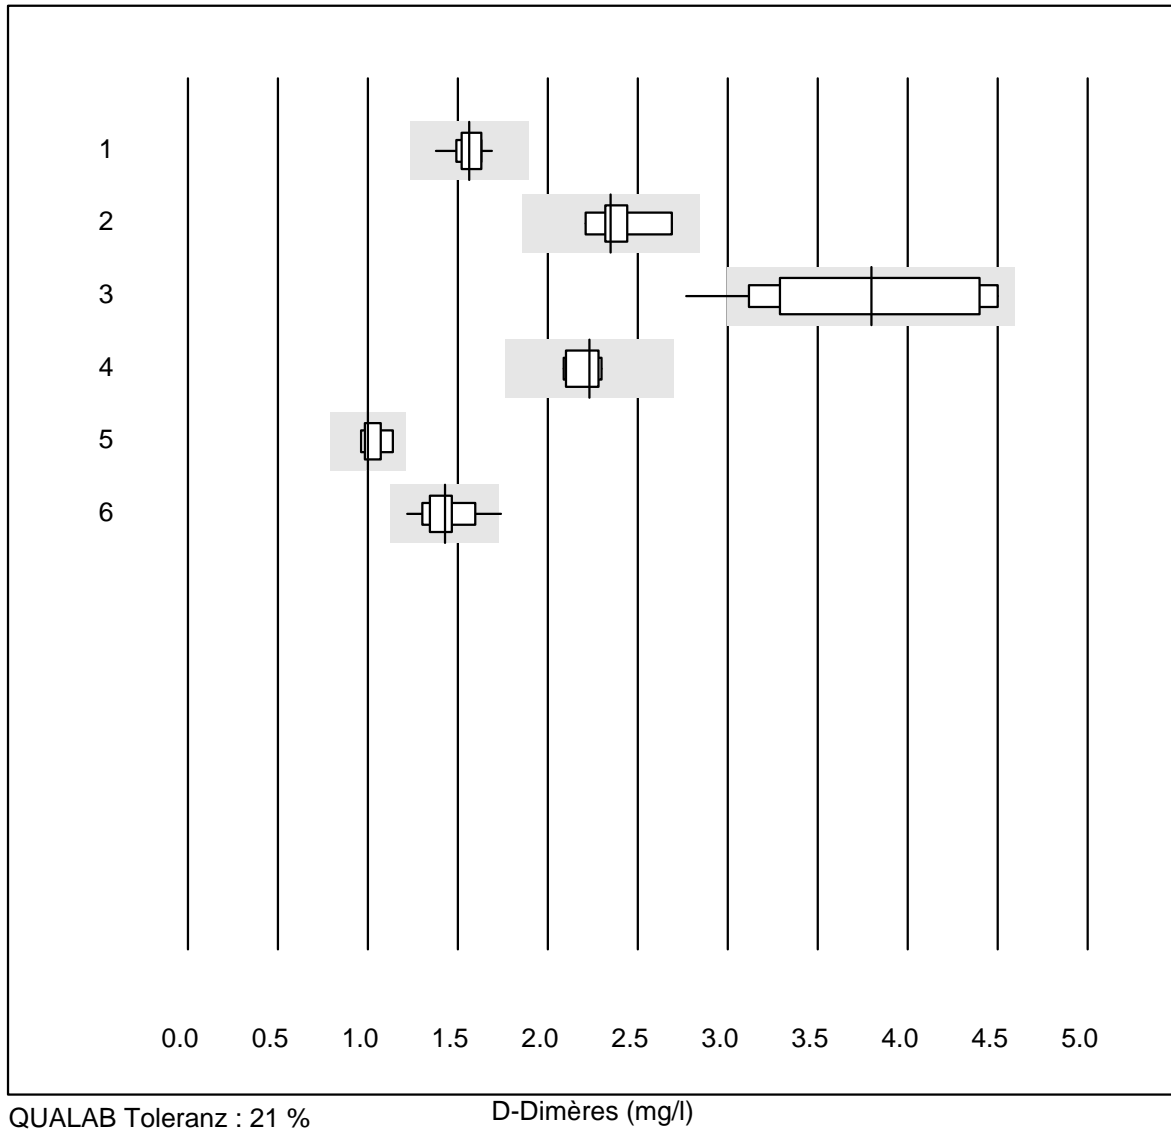


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 STA Liatest	11	100.0	0.0	0.0	1.56	5.3	e
2 Siemens Innovance	6	100.0	0.0	0.0	2.35	6.8	e*
3 Eurolyser	12	83.4	8.3	8.3	3.80	16.2	e*
4 ACL	7	100.0	0.0	0.0	2.23	3.9	e
5 AQT 90 FLEX	7	100.0	0.0	0.0	1.00	6.0	e
6 VIDAS	20	95.0	5.0	0.0	1.43	8.3	e

CoaguChek APTT

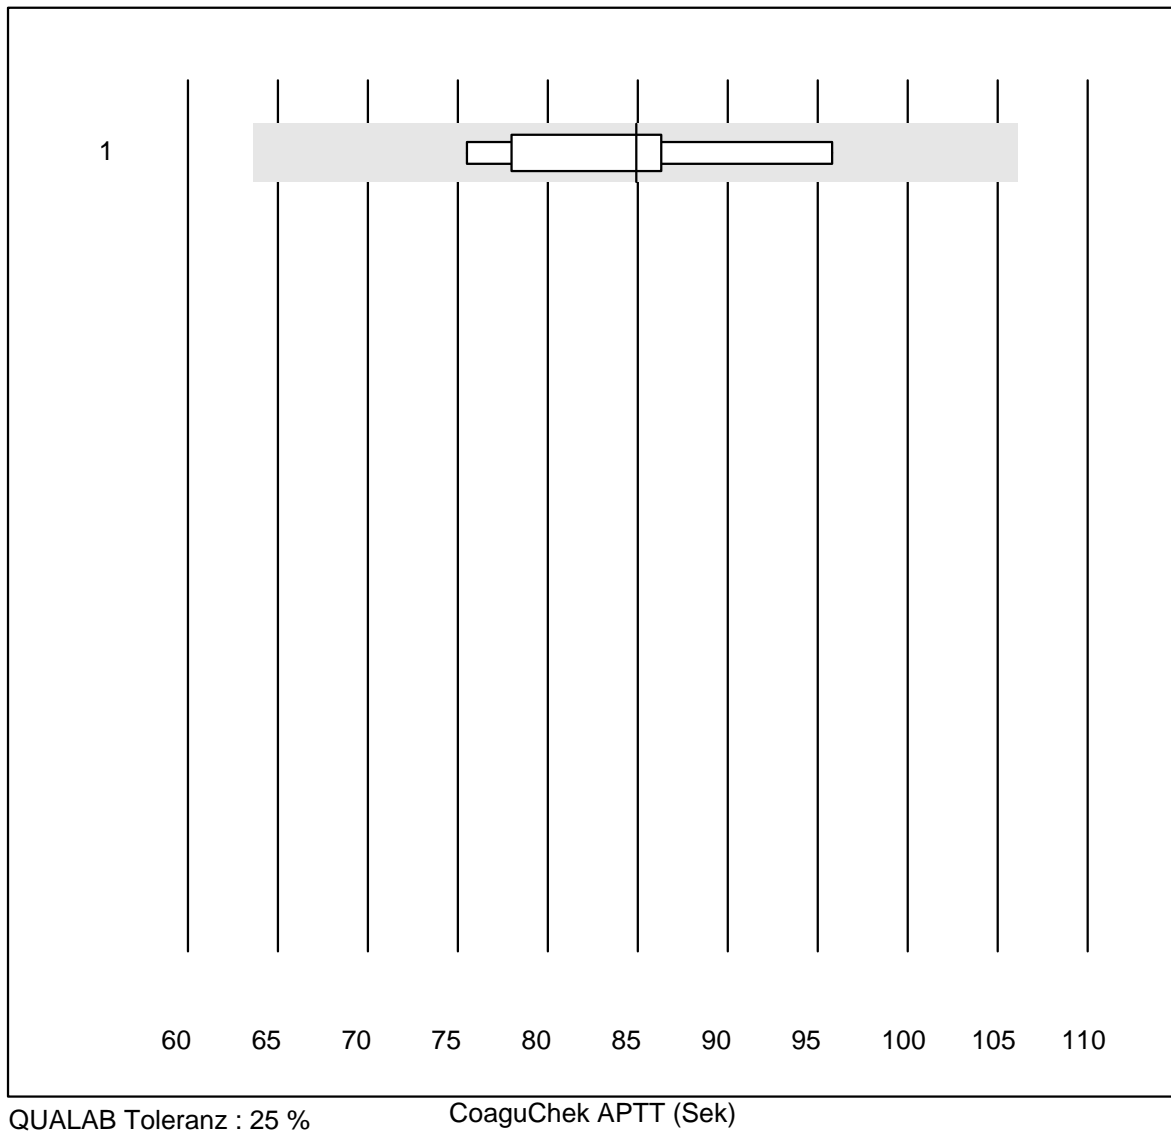

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	CoaguChek Pro II	9	100.0	0.0	0.0	84.9	7.6	e

INR CCXS

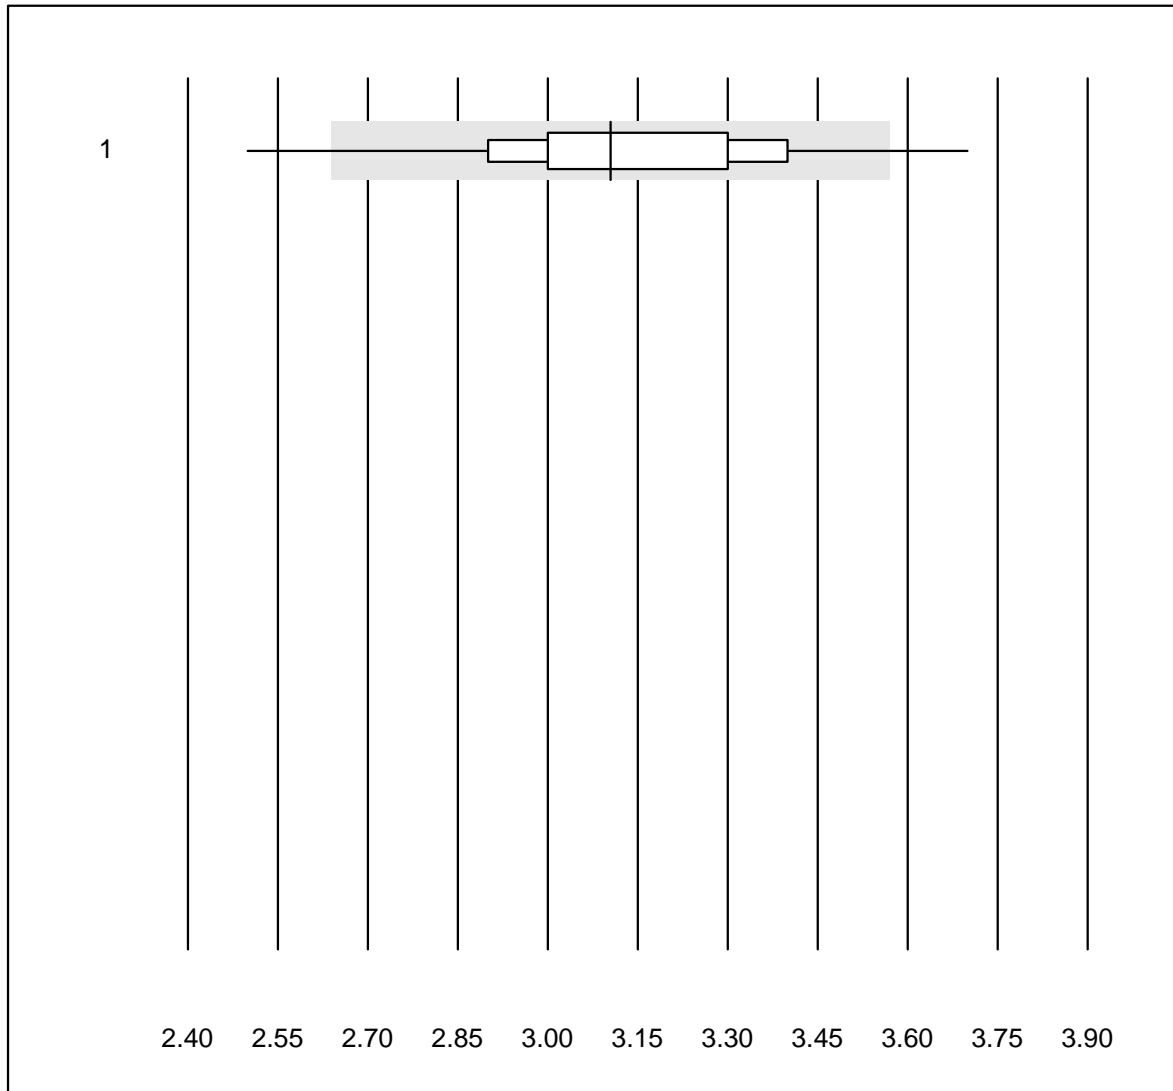


QUALAB Toleranz : 15 %

INR CCXS ()


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 CoaguChek XS	1960	96.7	2.6	0.7	3.1	6.5	e

INR HC

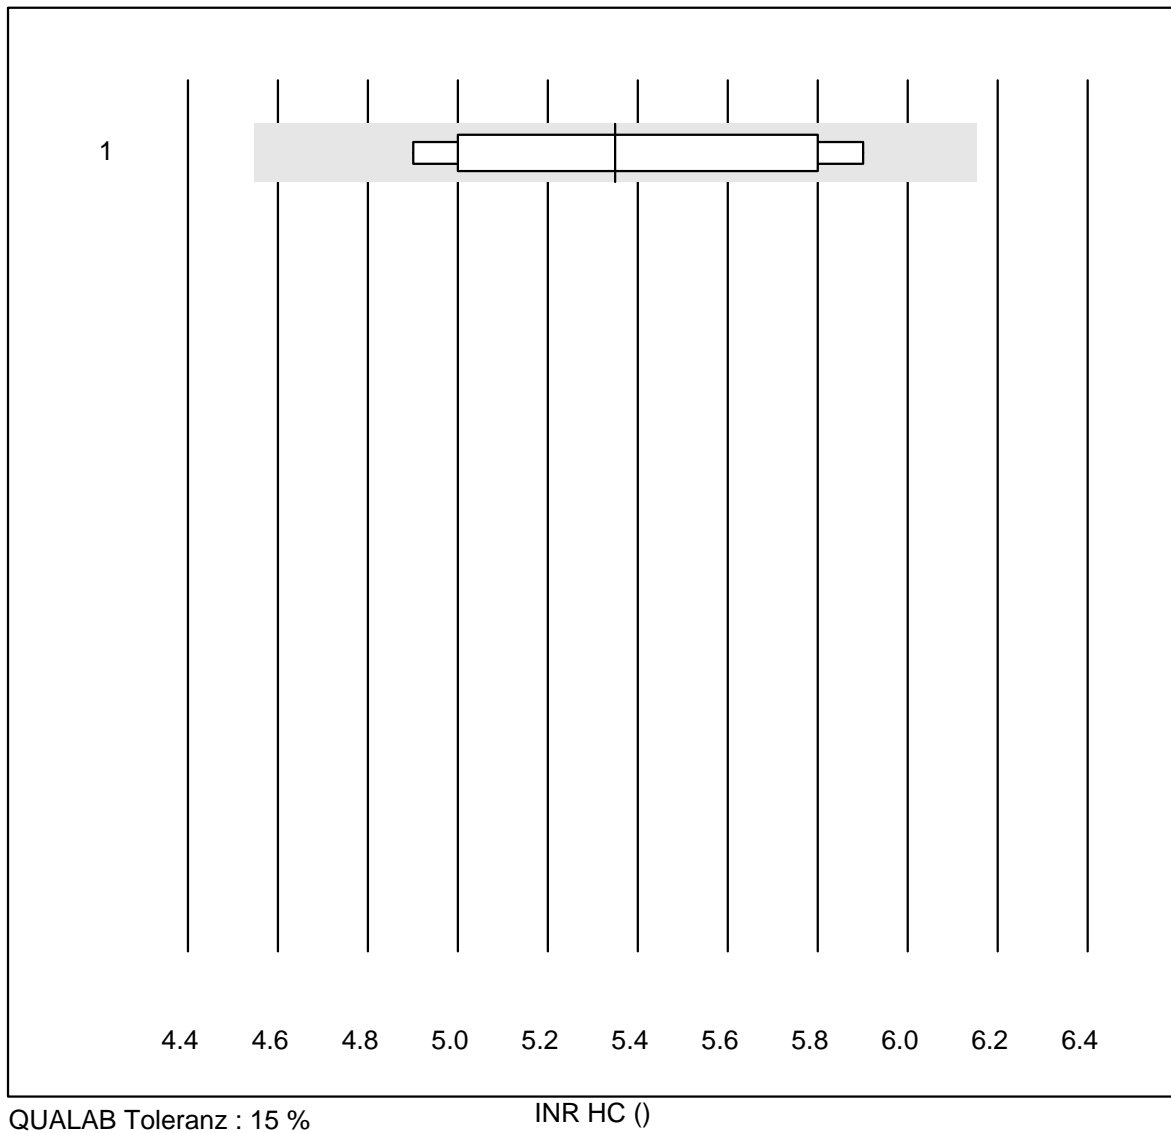


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Hemochron j.	10	100.0	0.0	0.0	5.4	7.6	e*

INR MI

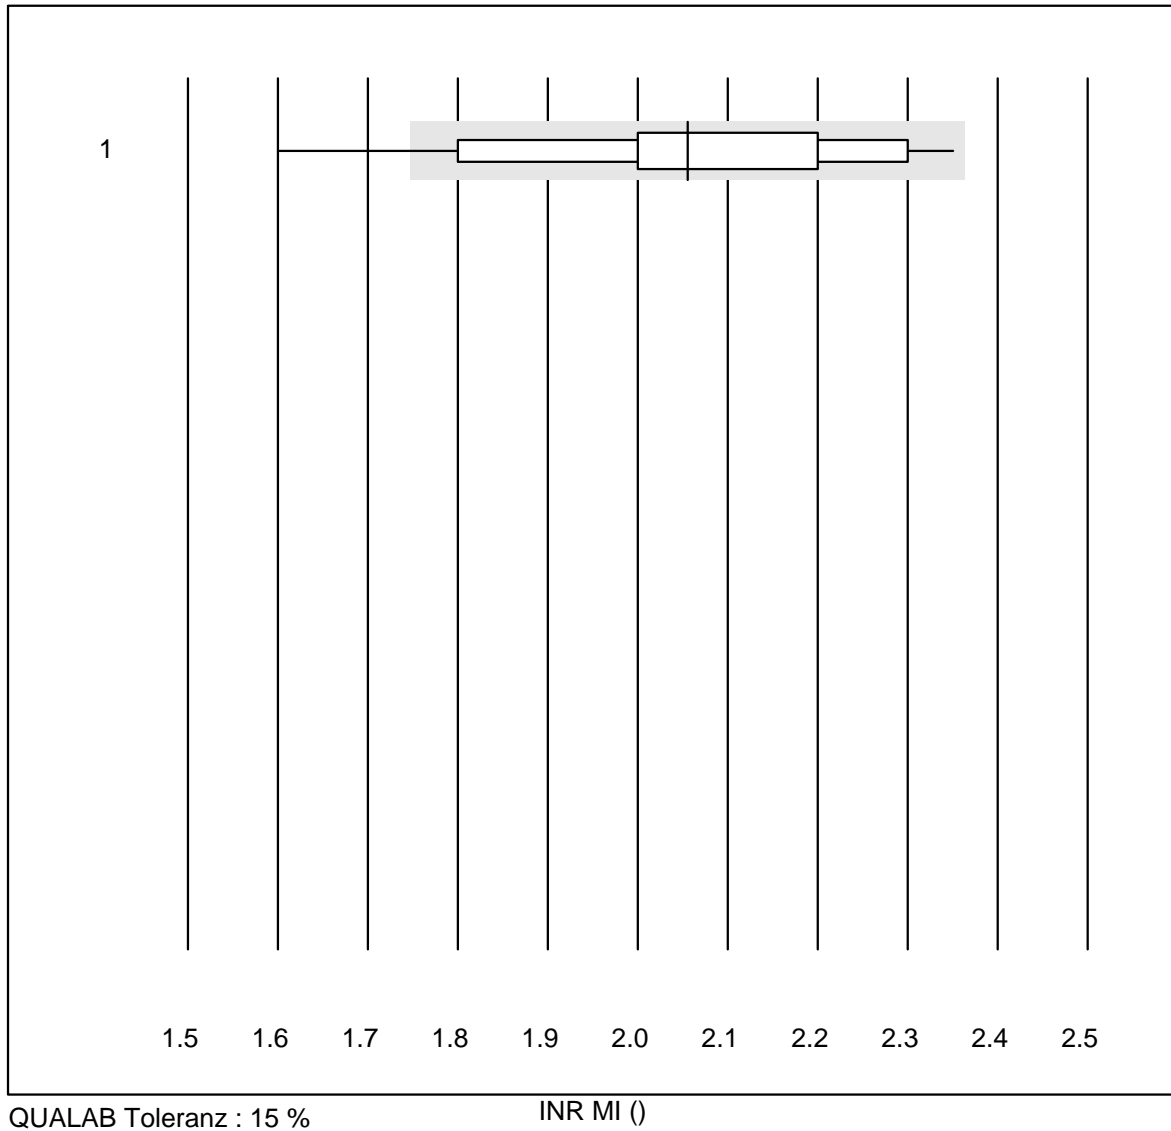


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 MicroINR	116	82.8	6.9	10.3	2.1	8.3	e

INR Xprecia

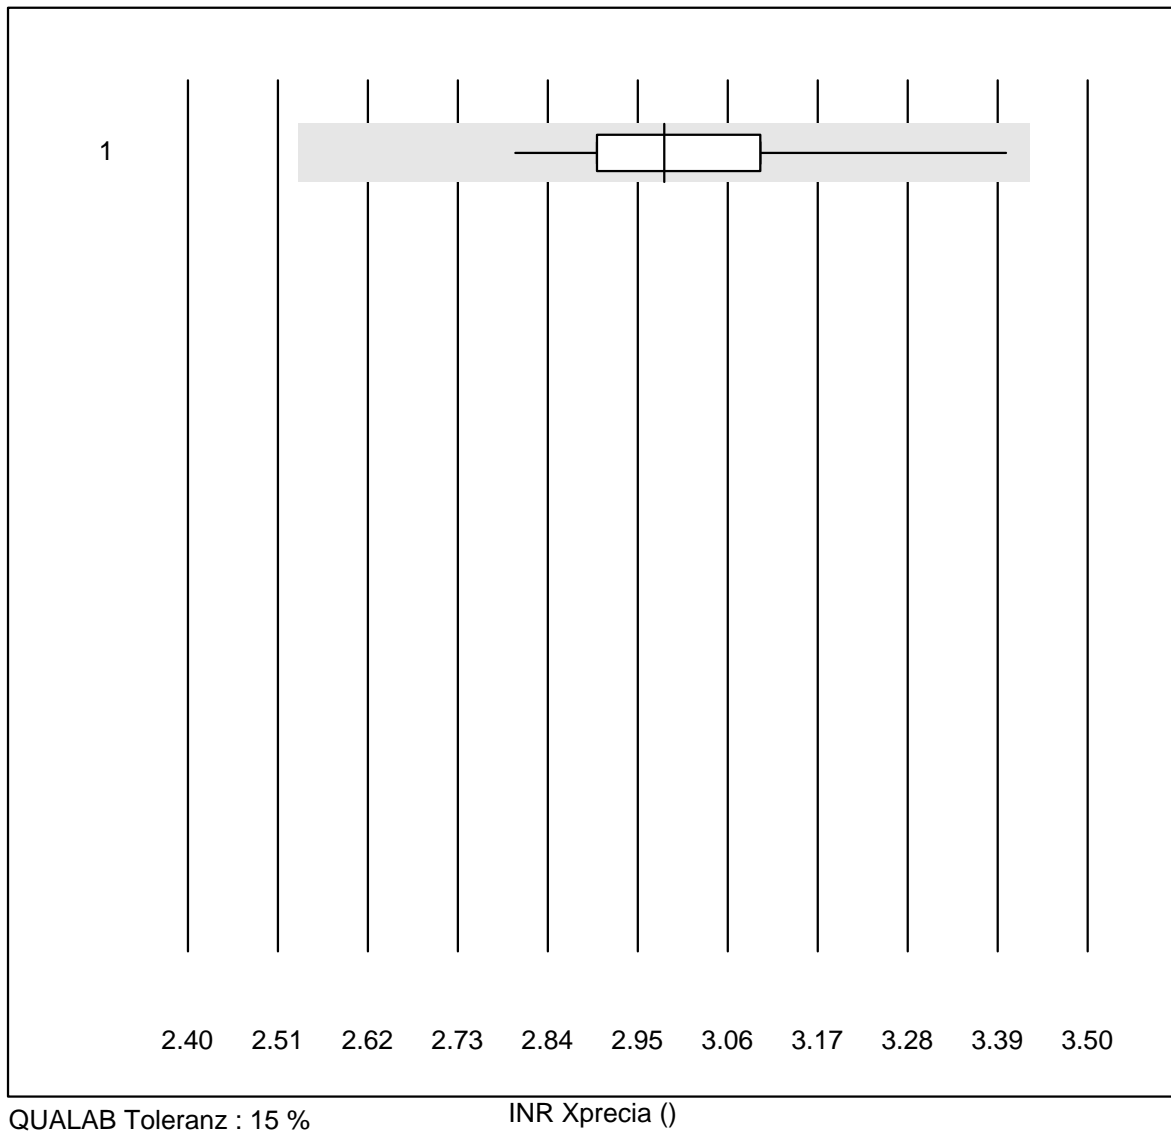

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Xprecia	62	100.0	0.0	0.0	3.0	3.9	e

Hémoglobine

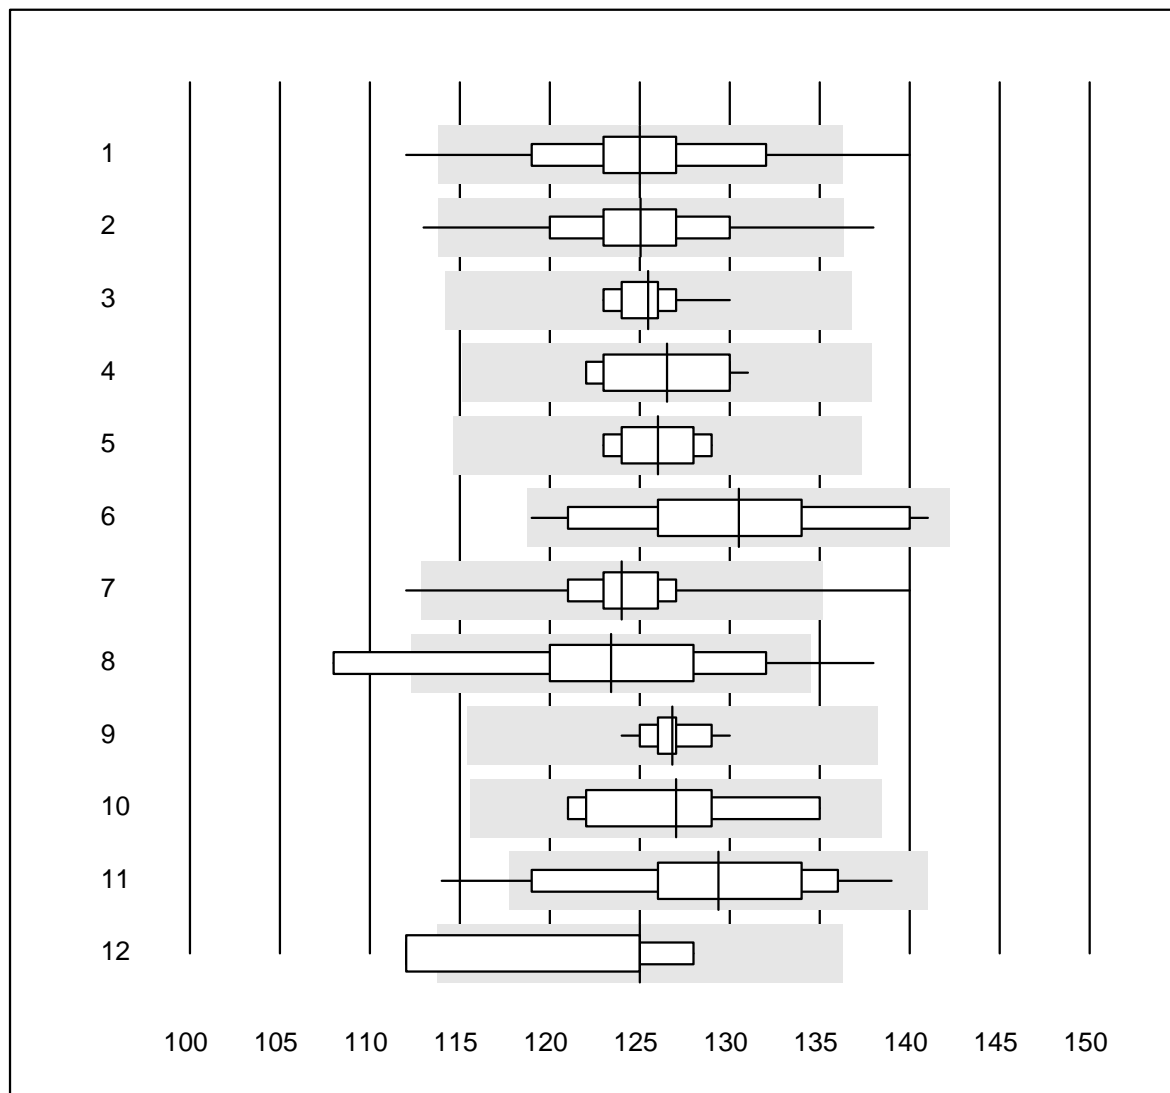


QUALAB Toleranz : 9 %

Hémoglobine (g/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Automate	27	85.2	11.1	3.7	125.0	4.6	e
2	Cyanmethémoglobine	34	94.1	5.9	0.0	125.0	3.5	e
3	Sysmex X	40	100.0	0.0	0.0	125.5	1.3	e
4	Advia 120	10	100.0	0.0	0.0	126.5	2.7	e
5	ABX Pentra	7	100.0	0.0	0.0	126.0	1.7	e
6	Reflotron	32	90.6	0.0	9.4	130.5	4.5	e
7	Hemocue	385	97.9	0.5	1.6	124.0	2.3	e
8	Dr. Lange	11	72.7	18.2	9.1	123.4	7.0	e*
9	Hemocontrol	11	100.0	0.0	0.0	126.8	1.3	e
10	Eurolyser	8	100.0	0.0	0.0	127.0	3.5	e*
11	DiaSpect	13	92.3	7.7	0.0	129.4	5.3	e*
12	Sysmex	4	75.0	25.0	0.0	125.0	5.8	e*

Hémoglobine

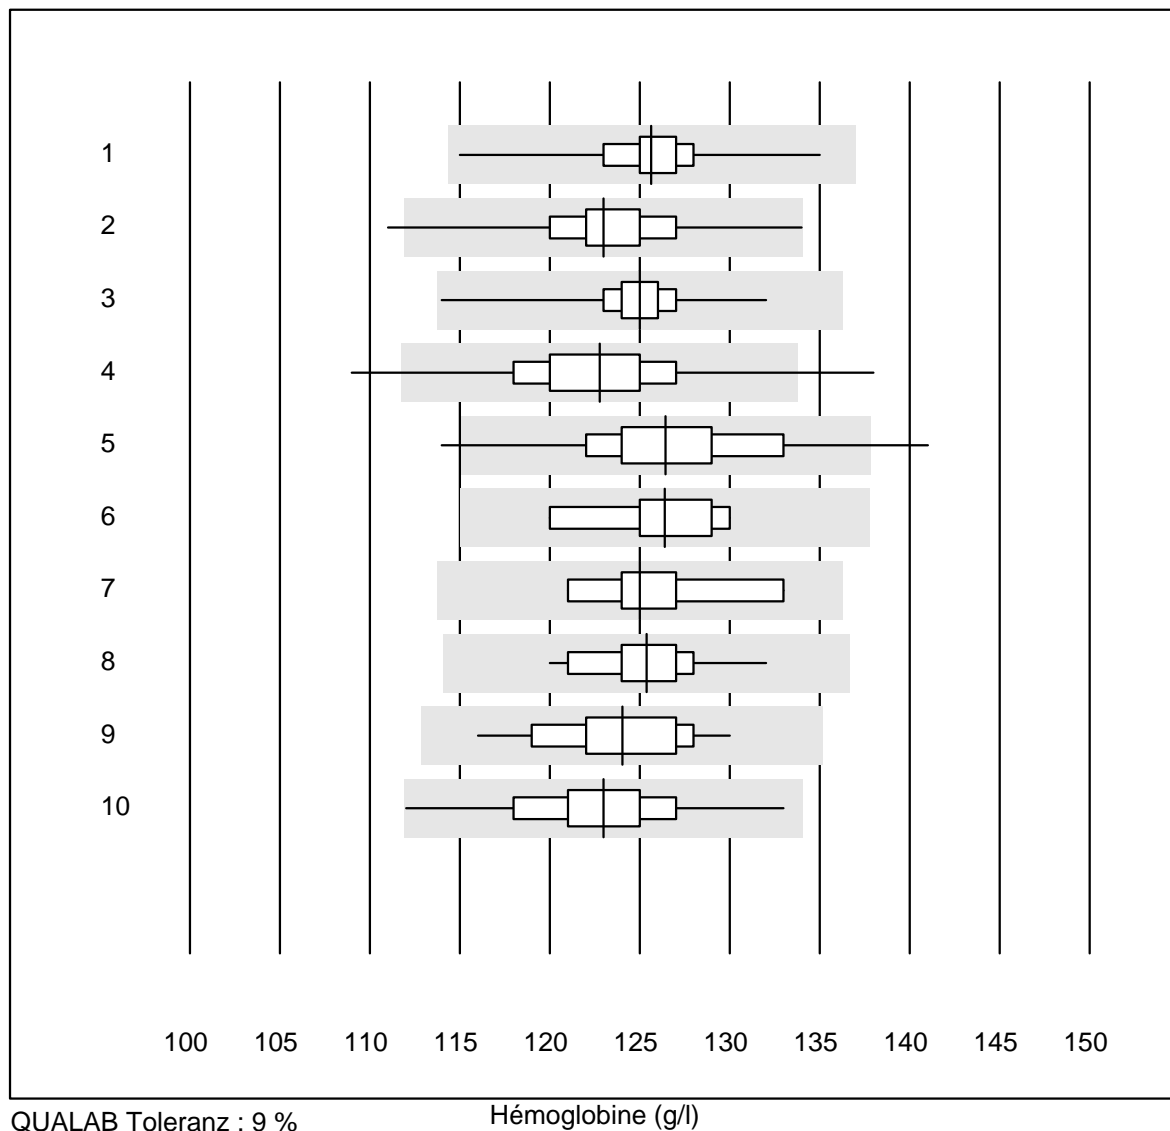

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex KX21	288	97.9	0.0	2.1	125.6	1.7	e
2	Sysmex PochH - 100i	197	98.5	0.5	1.0	123.0	2.5	e
3	Sysmex XP 300	483	99.2	0.0	0.8	125.0	1.5	e
4	Mythic	284	95.8	1.4	2.8	122.8	3.2	e
5	Swelab	49	89.8	6.1	4.1	126.4	3.9	e
6	Abacus Junior	10	100.0	0.0	0.0	126.4	2.5	e
7	Medonic	10	70.0	0.0	30.0	125.0	3.0	e
8	Celltac Alpha (Nihon	82	93.9	0.0	6.1	125.4	1.9	e
9	Samsung HC10	40	100.0	0.0	0.0	124.0	2.7	e
10	Micros 60	206	98.1	0.0	1.9	123.0	2.8	e

Hématocrite

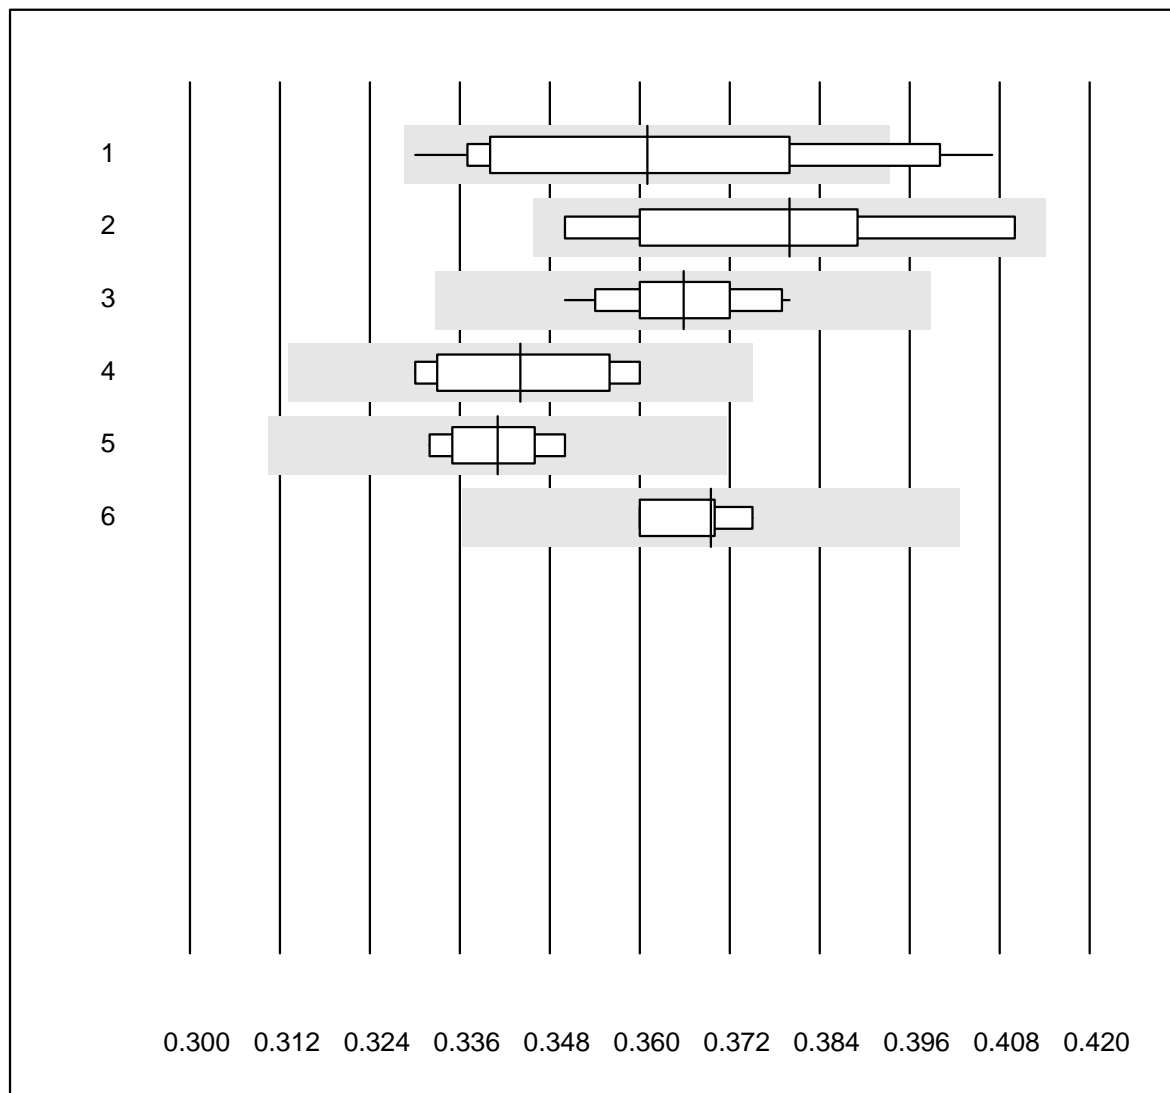


QUALAB Toleranz : 9 %

Hématocrite (l/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Automate	22	77.3	18.2	4.5	0.36	6.7	e*
2 Centrifuge	9	100.0	0.0	0.0	0.38	5.0	e*
3 Sysmex X	40	100.0	0.0	0.0	0.37	2.3	e
4 Advia 120	10	100.0	0.0	0.0	0.34	3.4	e
5 ABX Pentra	7	100.0	0.0	0.0	0.34	1.9	e
6 Sysmex	4	100.0	0.0	0.0	0.37	1.7	e

Hématocrite

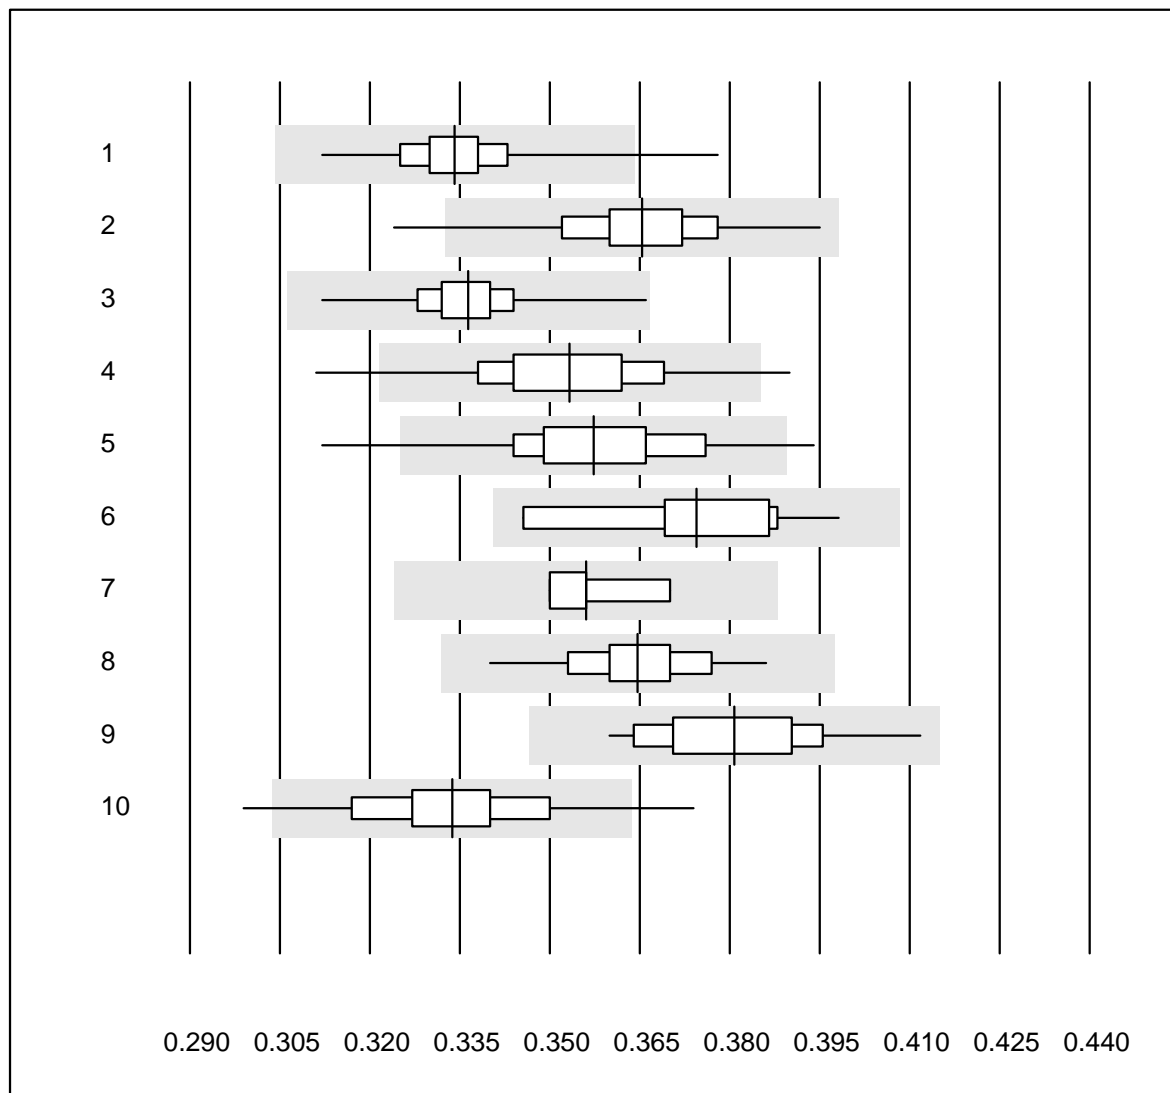


QUALAB Toleranz : 9 %

Hématocrite (l/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex KX21	287	97.6	0.7	1.7	0.33	2.4	e
2	Sysmex PochH - 100i	197	96.5	2.0	1.5	0.37	3.1	e
3	Sysmex XP 300	484	99.2	0.0	0.8	0.34	2.0	e
4	Mythic	284	95.4	1.8	2.8	0.35	3.7	e
5	Swelab	49	85.7	8.2	6.1	0.36	4.3	e
6	Abacus Junior	10	100.0	0.0	0.0	0.37	4.1	e*
7	Medonic	10	70.0	0.0	30.0	0.36	1.9	e
8	Celltac Alpha (Nihon	82	93.9	0.0	6.1	0.36	2.4	e
9	Samsung HC10	41	100.0	0.0	0.0	0.38	3.4	e
10	Micros 60	204	95.1	1.5	3.4	0.33	3.6	e

Erythrocytes

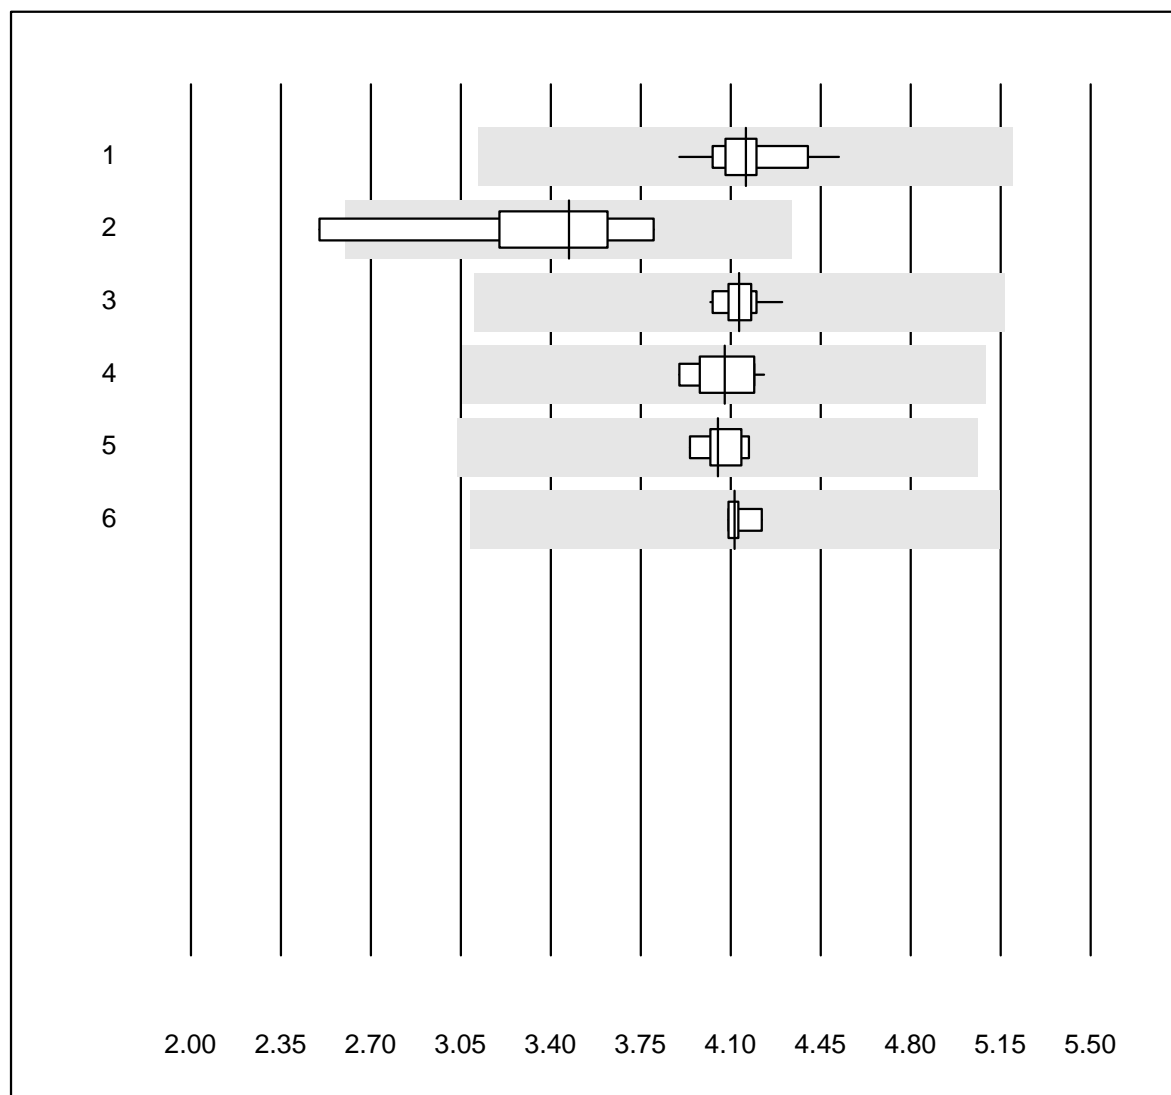


QUALAB Toleranz : 25 %

Erythrocytes (T/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Automate	19	94.7	0.0	5.3	4.16	3.6	e
2	Microscopie	5	80.0	20.0	0.0	3.47	15.3	e*
3	Sysmex X	40	100.0	0.0	0.0	4.13	1.5	e
4	Advia 120	10	100.0	0.0	0.0	4.08	2.7	e
5	ABX Pentra	7	100.0	0.0	0.0	4.05	1.9	e
6	Sysmex	4	100.0	0.0	0.0	4.12	1.4	e

Erythrocytes

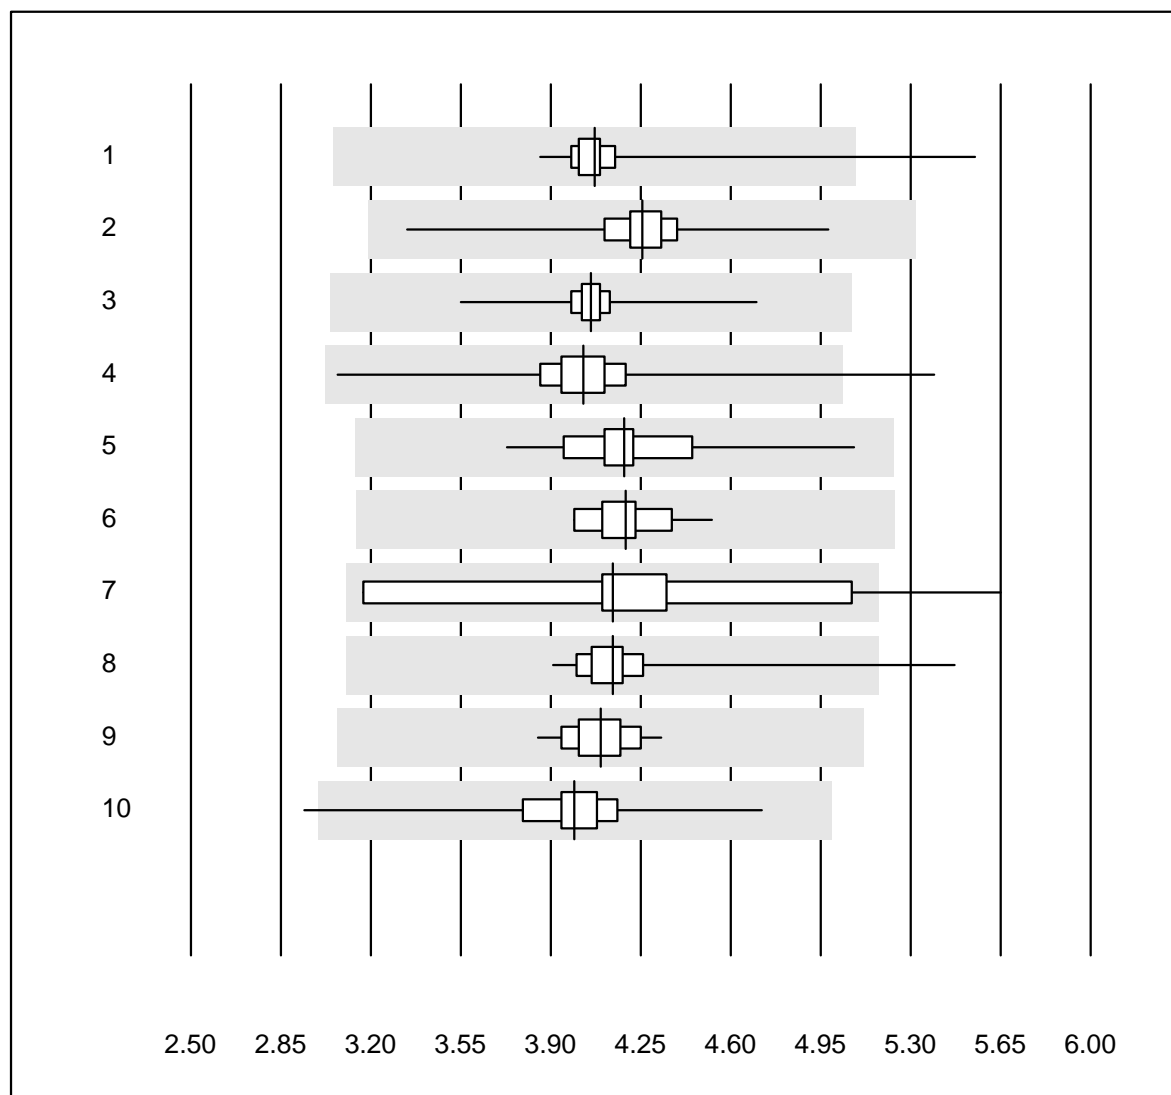


QUALAB Toleranz : 25 %

Erythrocytes (T/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex KX21	287	98.0	0.3	1.7	4.07	3.4	e
2	Sysmex PochH - 100i	197	100.0	0.0	0.0	4.26	3.3	e
3	Sysmex XP 300	484	99.0	0.0	1.0	4.06	1.9	e
4	Mythic	284	97.5	0.4	2.1	4.03	4.4	e
5	Swelab	49	98.0	0.0	2.0	4.19	5.0	e
6	Abacus Junior	10	100.0	0.0	0.0	4.19	3.7	e
7	Medonic	10	90.0	10.0	0.0	4.14	15.3	e*
8	Celltac Alpha (Nihon	82	93.9	1.2	4.9	4.14	4.7	e
9	Samsung HC10	41	100.0	0.0	0.0	4.09	2.9	e
10	Micros 60	205	98.0	0.5	1.5	3.99	4.5	e

Leucocytes

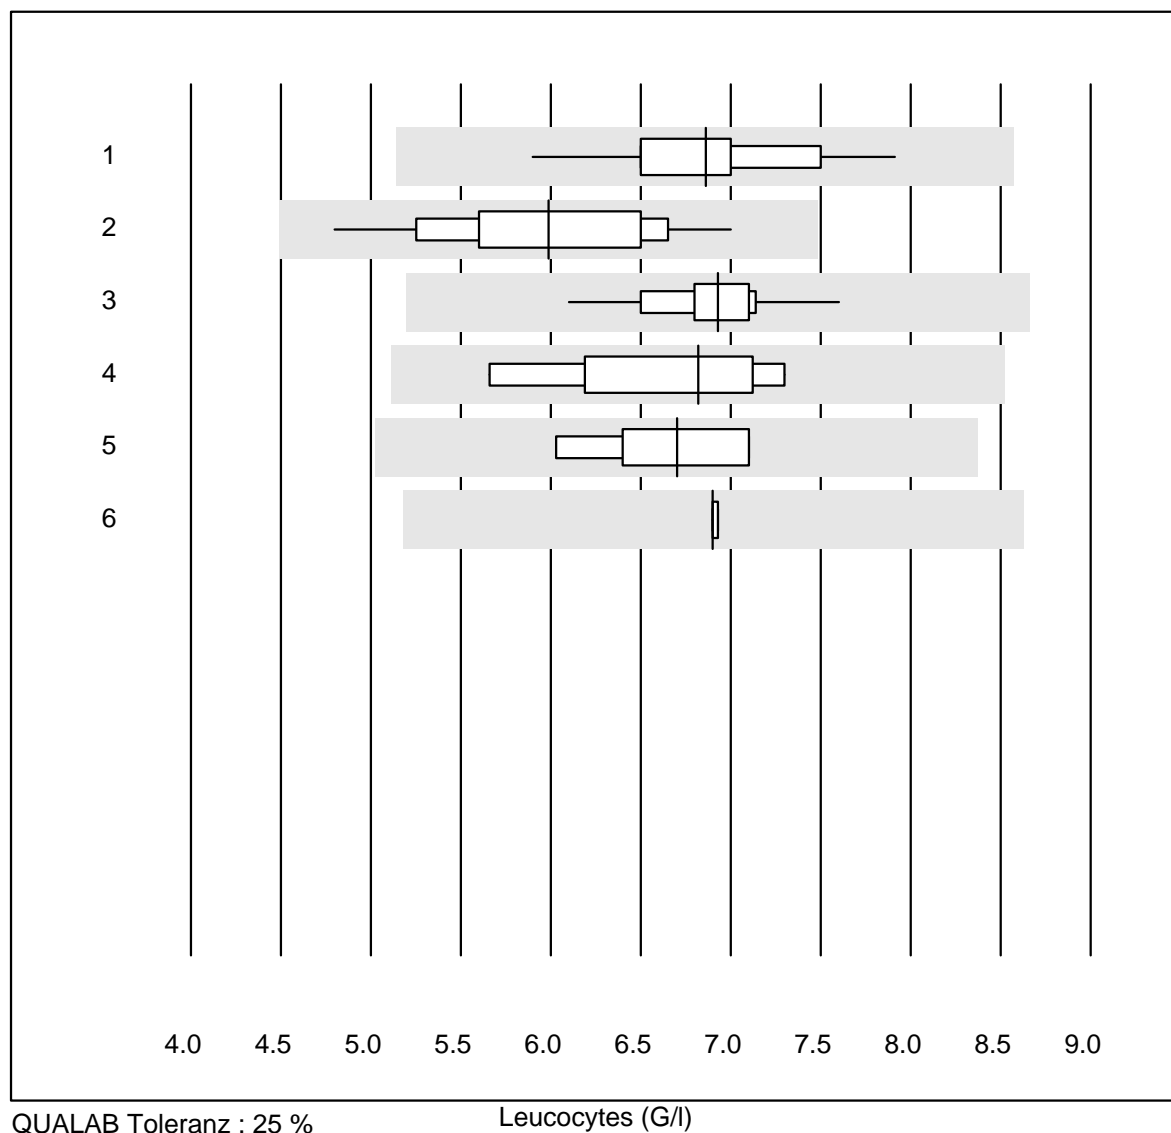

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Automate	18	94.4	0.0	5.6	6.86	6.9	e
2	Microscopie	27	88.9	0.0	11.1	5.99	9.6	e
3	Sysmex X	40	97.5	0.0	2.5	6.93	4.3	e
4	Advia 120 (Perox)	9	100.0	0.0	0.0	6.82	9.3	e*
5	ABX Pentra	7	100.0	0.0	0.0	6.70	5.8	e
6	Sysmex	4	75.0	0.0	25.0	6.90	0.3	e

Leucocytes

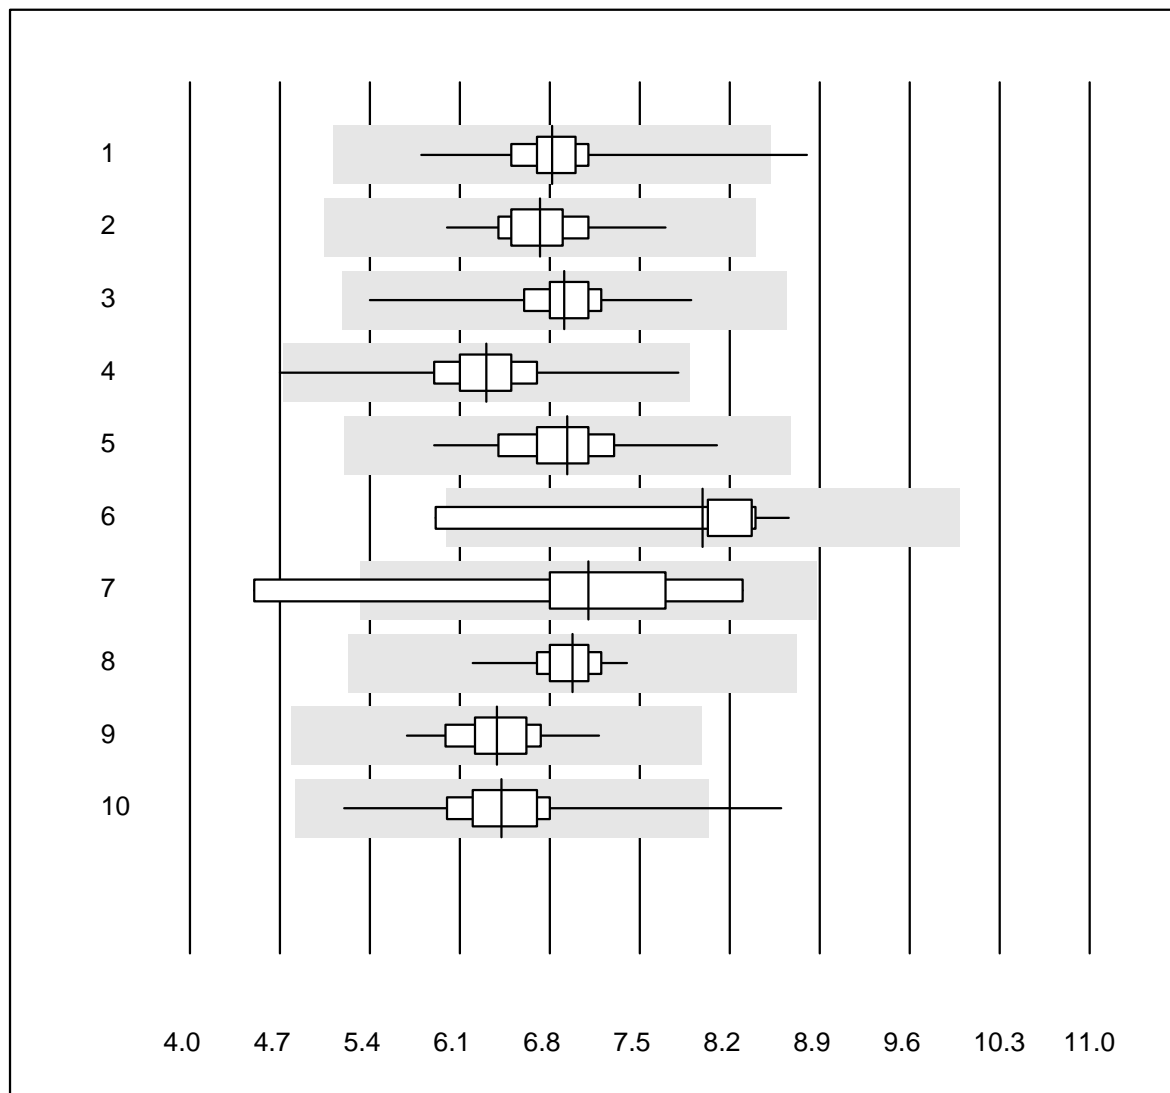


QUALAB Toleranz : 25 %

Leucocytes (G/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex KX21	287	99.7	0.3	0.0	6.82	4.1	e
2	Sysmex PochH - 100i	197	100.0	0.0	0.0	6.72	4.0	e
3	Sysmex XP 300	484	99.2	0.0	0.8	6.91	4.0	e
4	Mythic	283	98.9	0.7	0.4	6.31	6.2	e
5	Swelab	49	100.0	0.0	0.0	6.94	5.6	e
6	Abacus Junior	10	90.0	10.0	0.0	7.99	9.7	e*
7	Medonic	10	90.0	10.0	0.0	7.10	16.5	e*
8	Celltac Alpha (Nihon	82	97.6	0.0	2.4	6.98	3.0	e
9	Samsung HC10	41	100.0	0.0	0.0	6.39	5.0	e
10	Micros 60	205	98.5	0.5	1.0	6.43	6.4	e

Thrombocytes

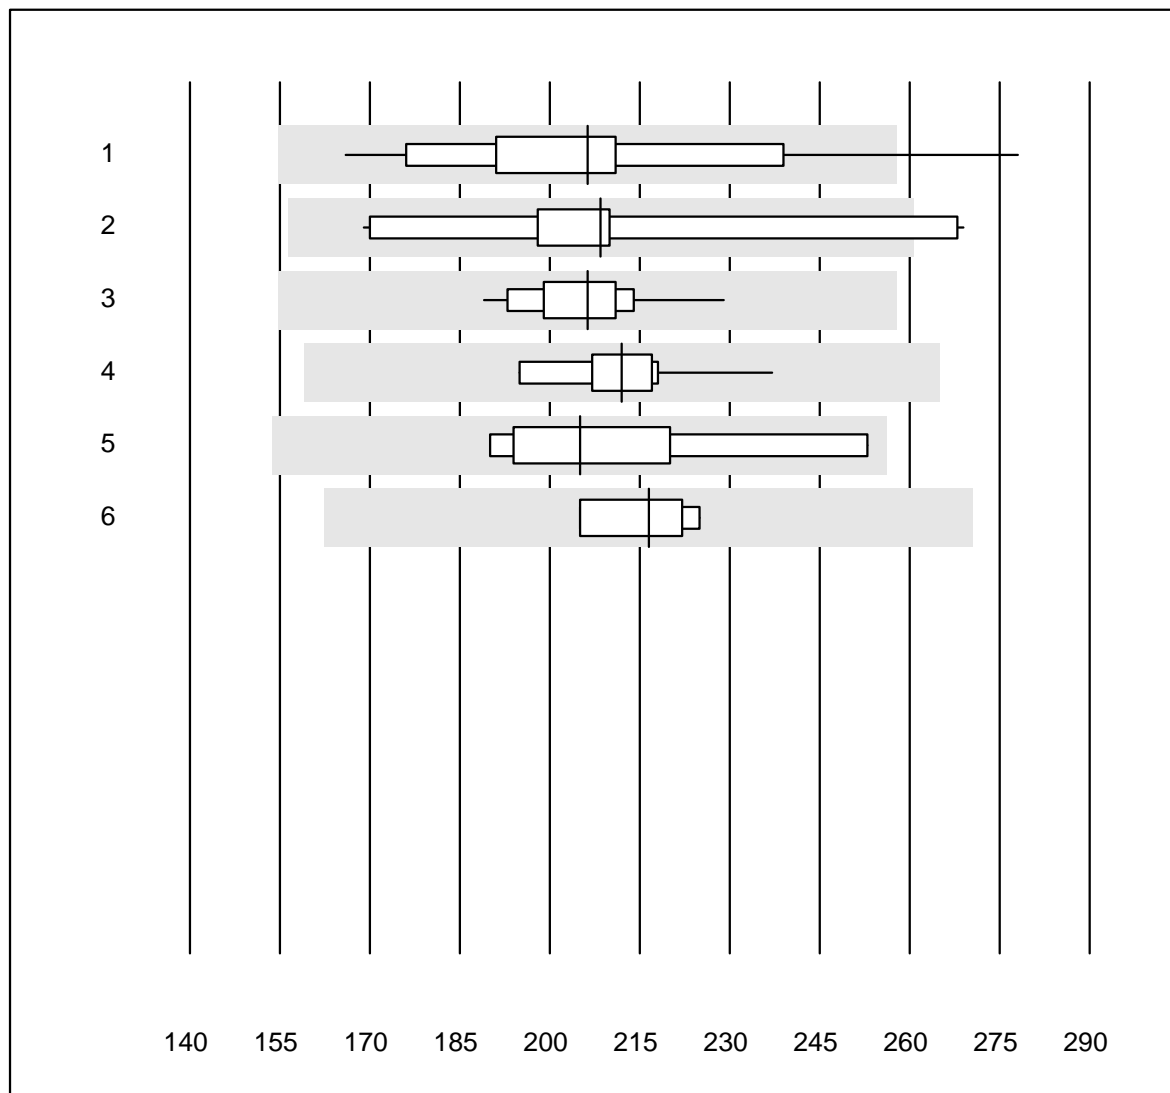


QUALAB Toleranz : 25 %

Thrombocytes (G/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Automate	16	93.7	6.3	0.0	206.3	13.2	e*
2	Microscopie	18	88.9	11.1	0.0	208.5	12.9	e*
3	Sysmex X	40	100.0	0.0	0.0	206.3	4.4	e
4	Advia 120	10	100.0	0.0	0.0	212.0	5.5	e
5	ABX Pentra	7	100.0	0.0	0.0	205.0	10.0	e*
6	Sysmex	4	100.0	0.0	0.0	216.5	4.3	e

Thrombocytes

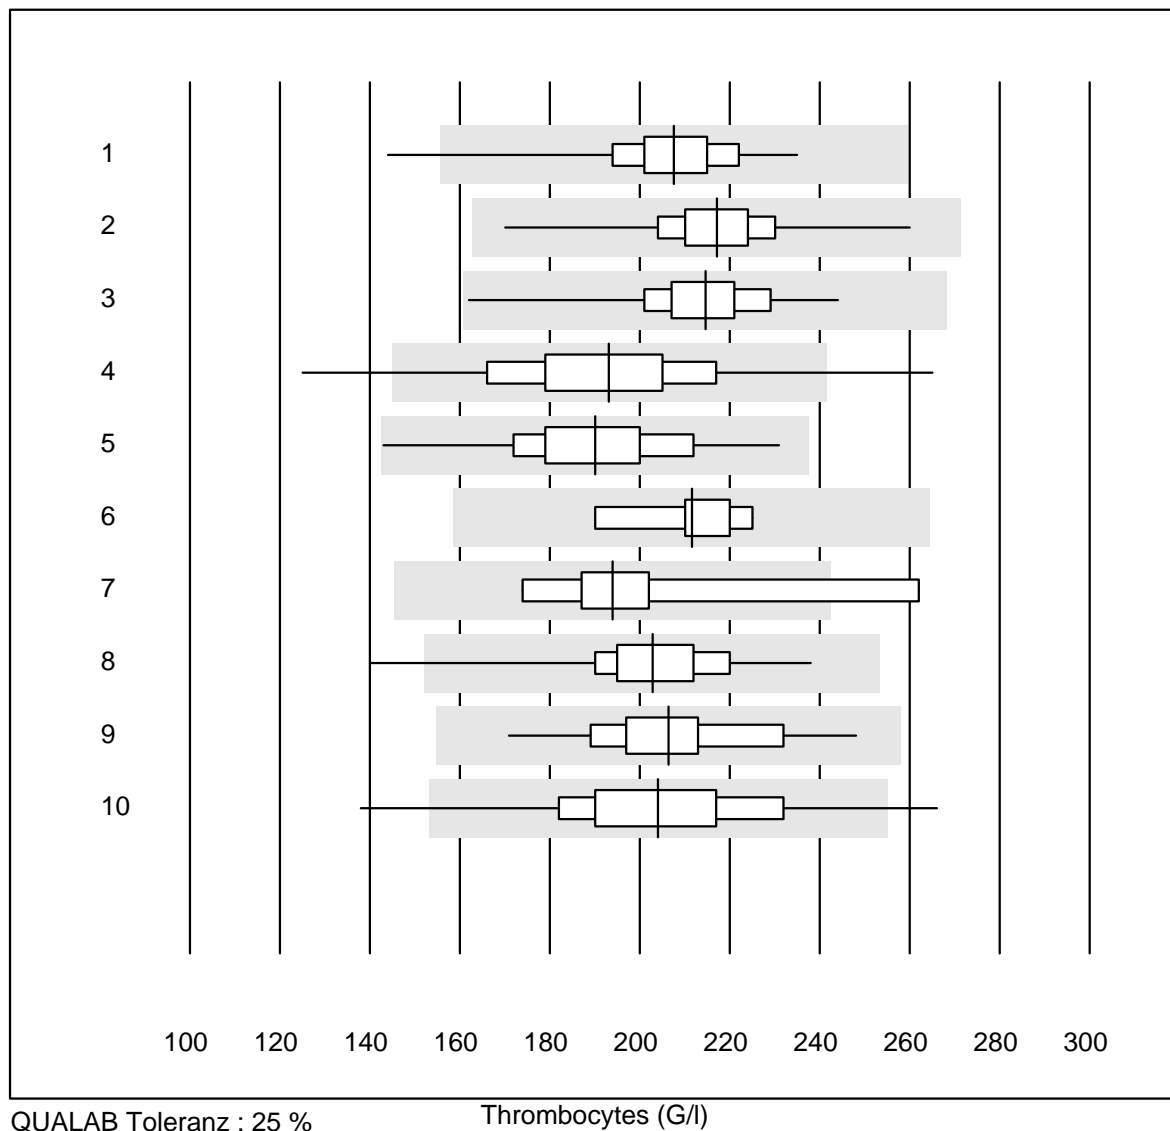


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex KX21	287	99.4	0.3	0.3	207.5	5.6	e
2	Sysmex PochH - 100i	197	99.0	0.0	1.0	217.1	5.2	e
3	Sysmex XP 300	484	99.8	0.0	0.2	214.5	5.2	e
4	Mythic	284	93.7	4.9	1.4	193.2	11.3	e
5	Swelab	49	100.0	0.0	0.0	190.1	8.4	e
6	Abacus Junior	10	100.0	0.0	0.0	211.6	5.4	e
7	Medonic	10	80.0	10.0	10.0	194.0	13.2	e*
8	Celltac Alpha (Nihon	81	98.8	1.2	0.0	202.8	7.7	e
9	Samsung HC10	41	100.0	0.0	0.0	206.4	8.0	e
10	Micros 60	205	96.6	2.9	0.5	204.1	10.2	e

Hémoglobine H2

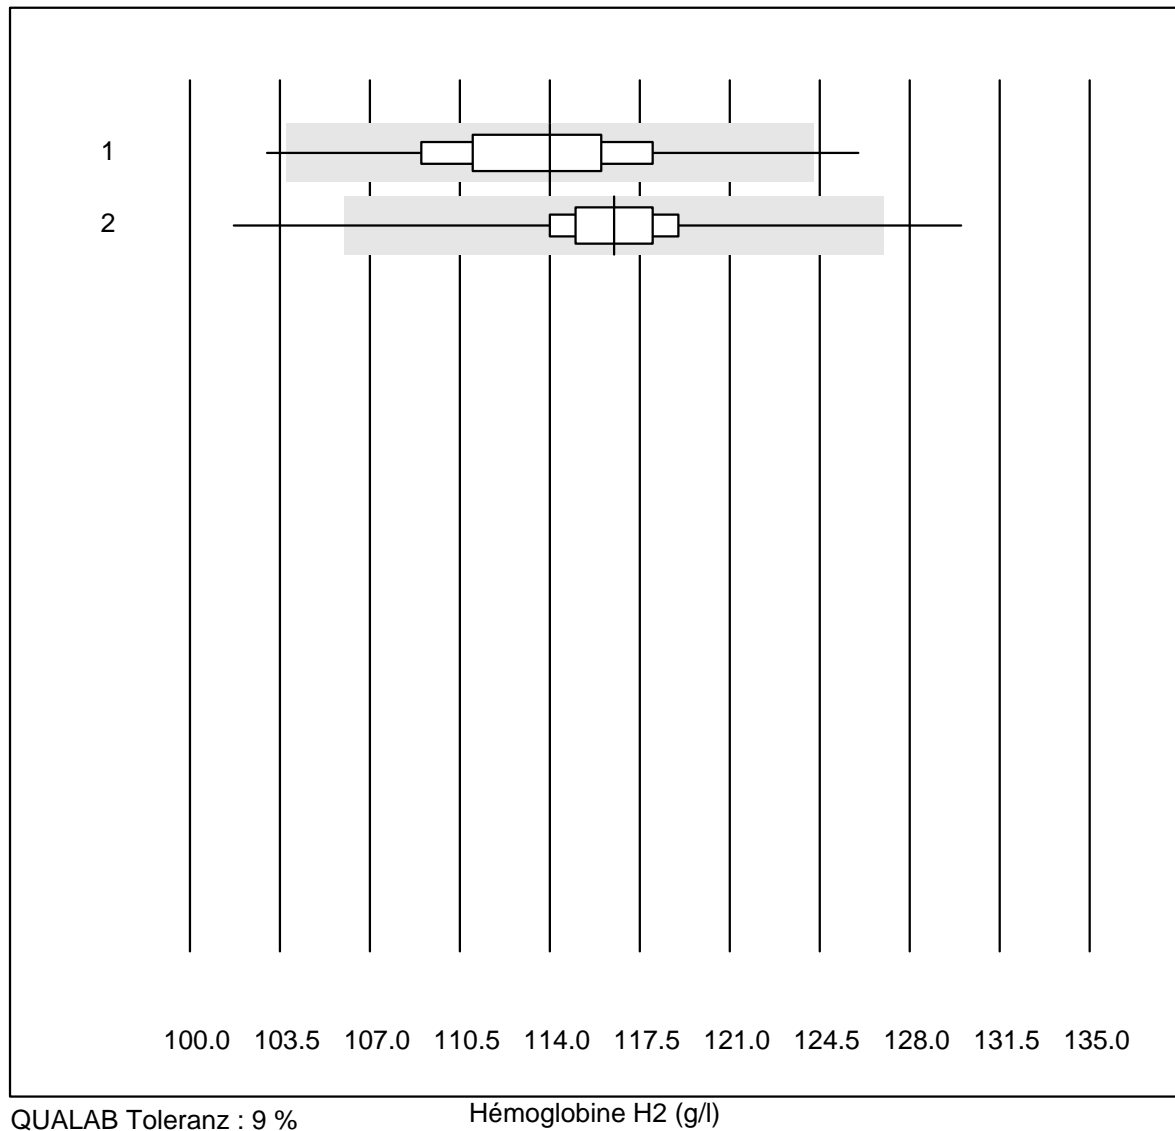

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Abx Micros	195	92.9	1.5	5.6	114.0	3.2	e
2	Microsemi	682	97.0	1.2	1.8	116.5	2.2	e

Hématocrite H2

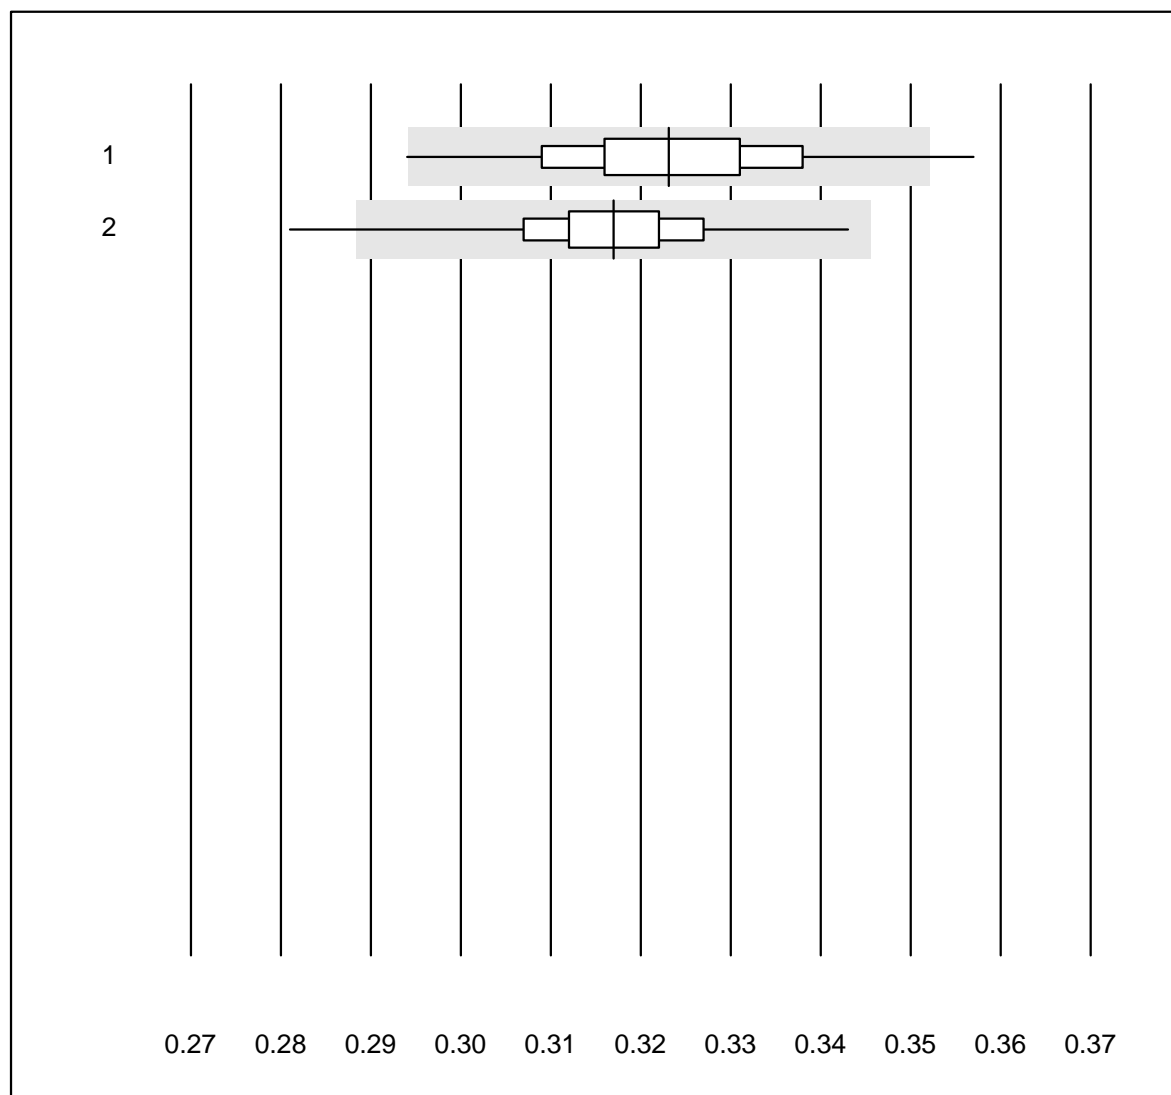


QUALAB Toleranz : 9 %

Hématocrite H2 (l/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Abx Micros	195	93.9	1.5	4.6	0.32	3.6	e
2 Microsemi	683	97.2	0.6	2.2	0.32	2.6	e

Leucocytes H2

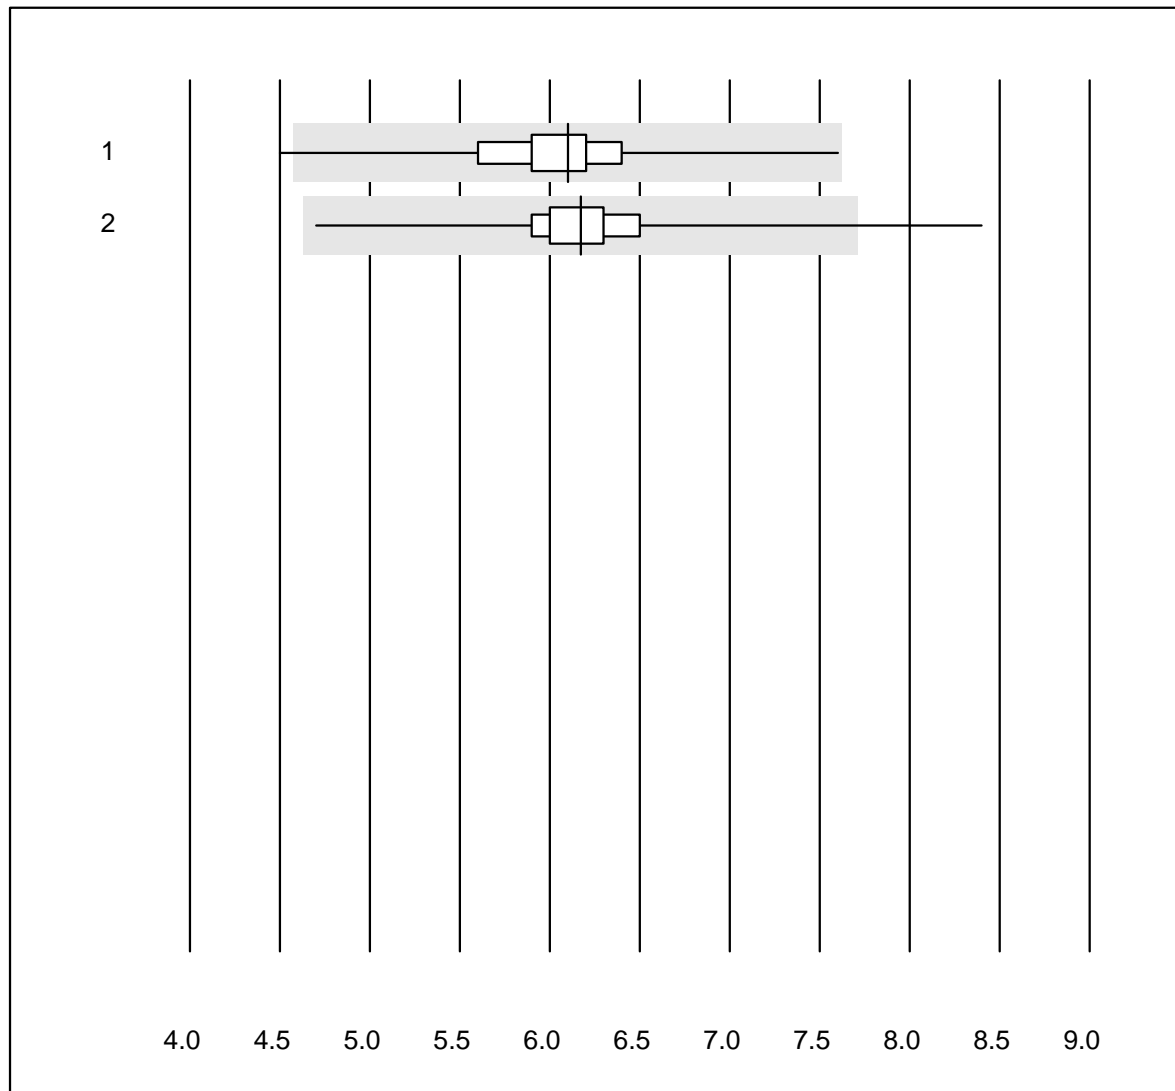


QUALAB Toleranz : 25 %

Leucocytes H2 (G/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Abx Micros	195	97.4	0.5	2.1	6.10	6.1	e
2	Microsemi	683	99.0	0.1	0.9	6.17	4.4	e

Thrombocytes H2

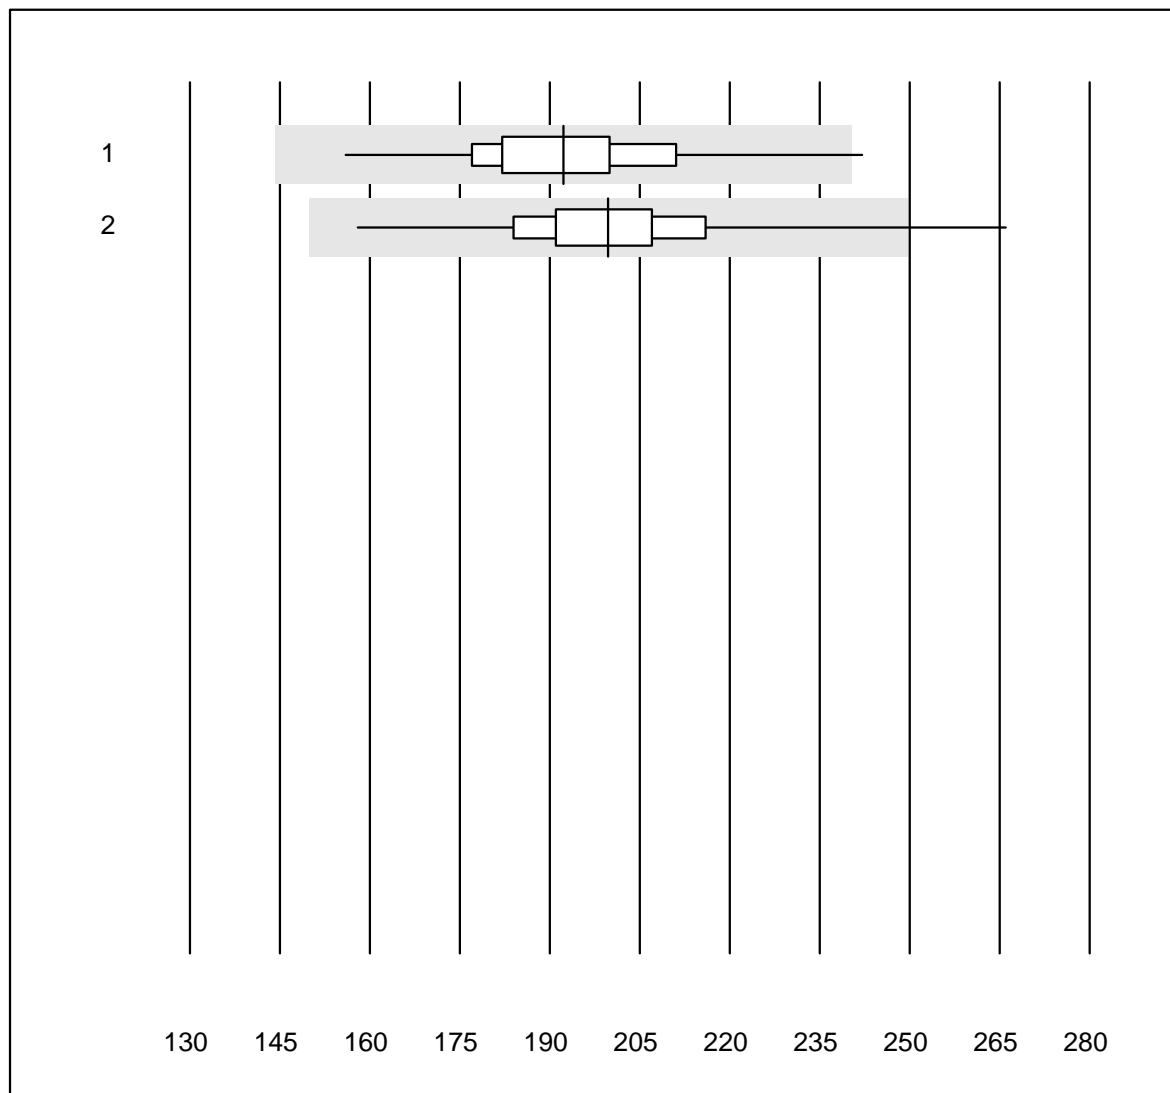


QUALAB Toleranz : 25 %

Thrombocytes H2 (G/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Abx Micros	194	93.8	0.5	5.7	192.3	7.6	e
2	Microsemi	683	99.0	0.4	0.6	199.7	6.7	e

Erythrocytes H2

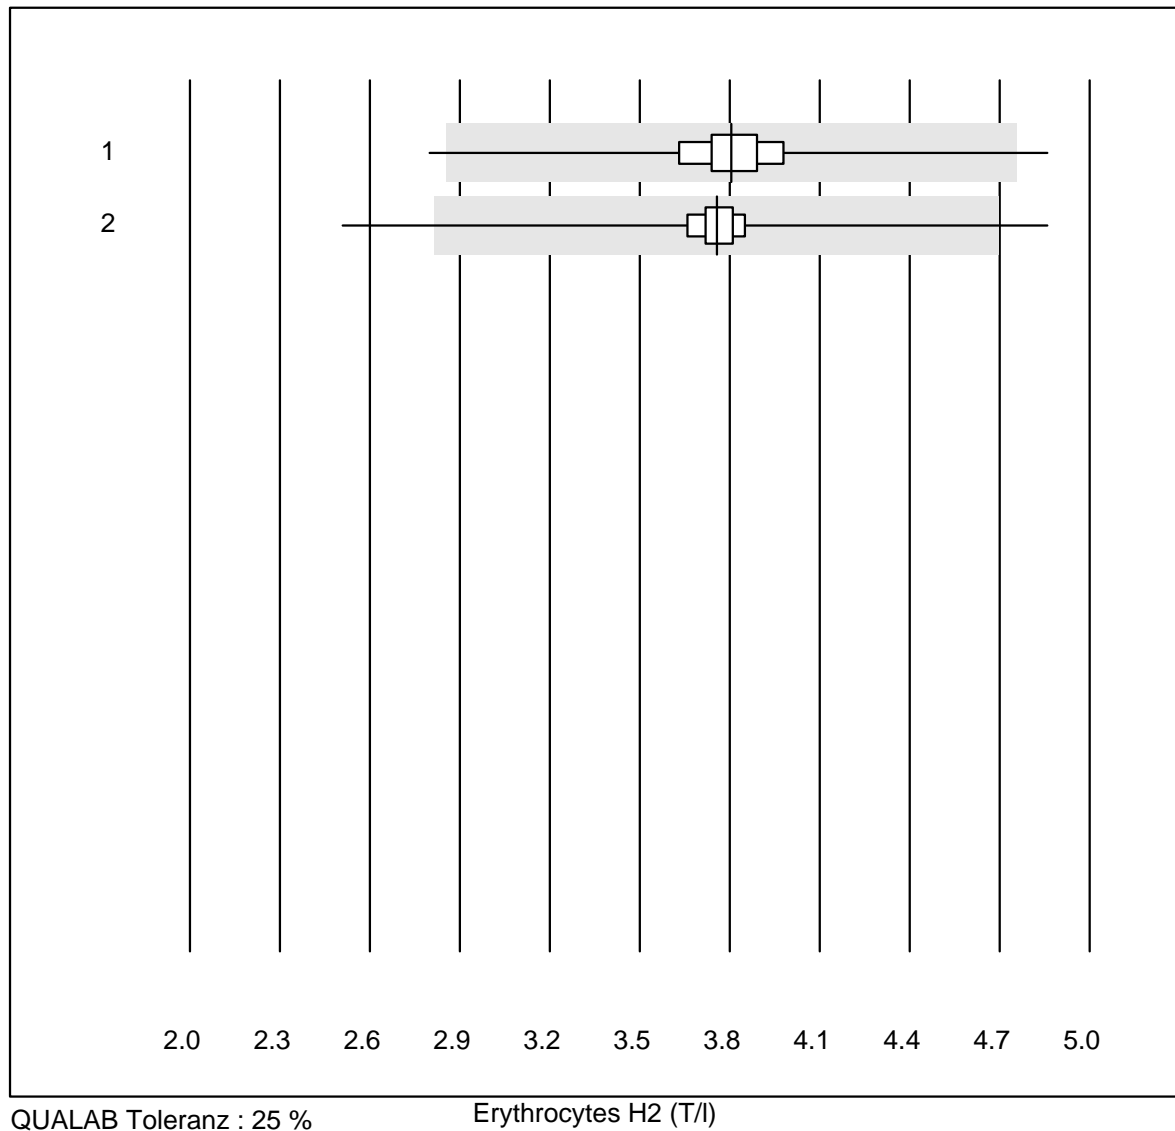

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Abx Micros	194	95.4	1.0	3.6	3.80	4.7	e
2	Microsemi	682	98.1	0.6	1.3	3.76	3.6	e

CRP H2

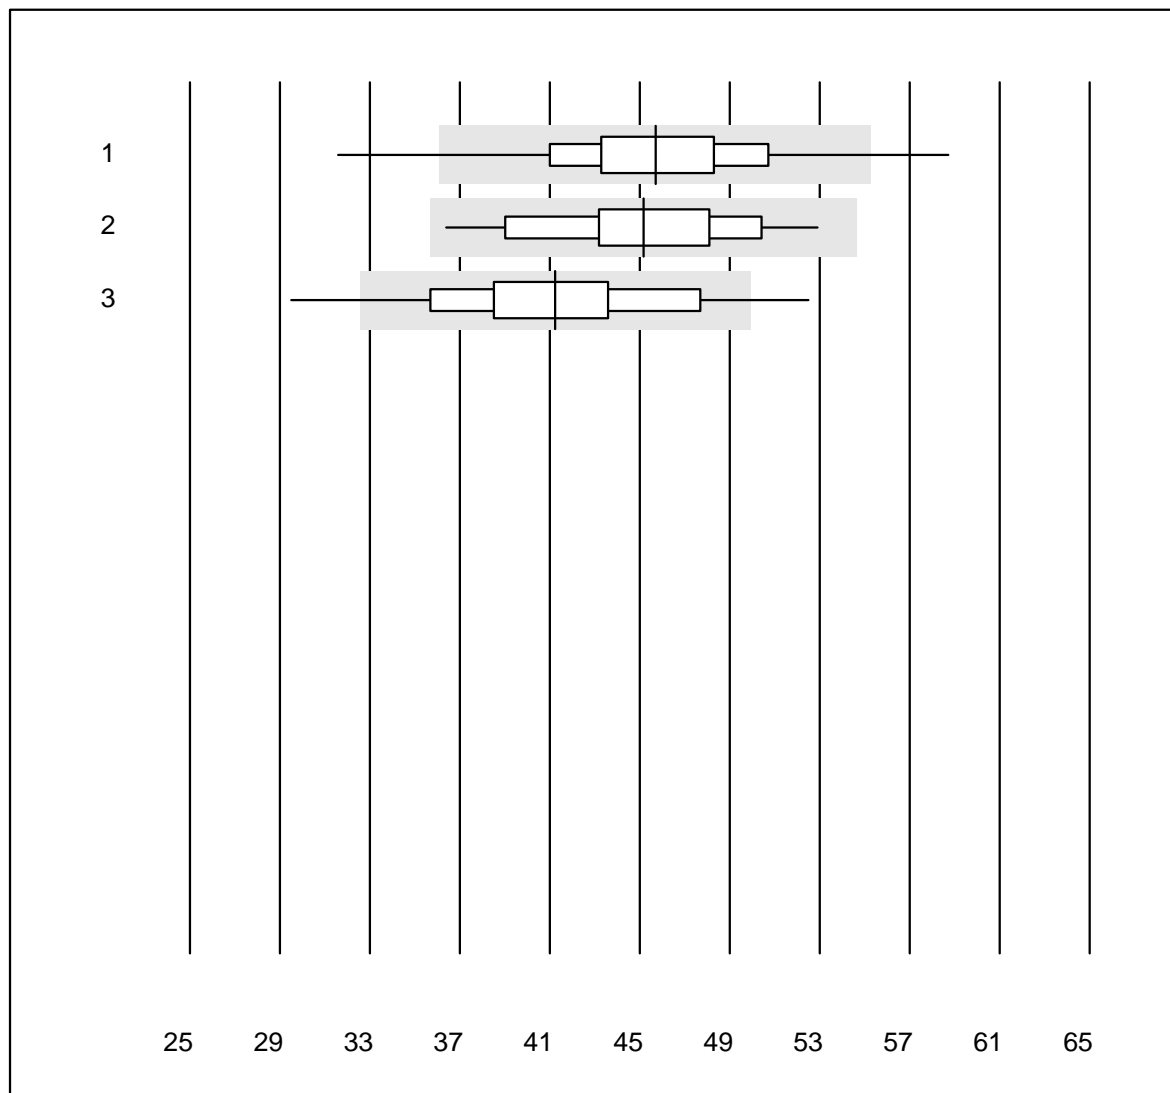


QUALAB Toleranz : 21 %

CRP H2 (mg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Microsemi	676	95.1	2.5	2.4	45.7	8.7	e
2	Abx Micros	18	94.4	0.0	5.6	45.2	9.5	e
3	ABX Micros CRP200	170	91.7	5.9	2.4	41.2	10.8	e

Hémoglobine BG

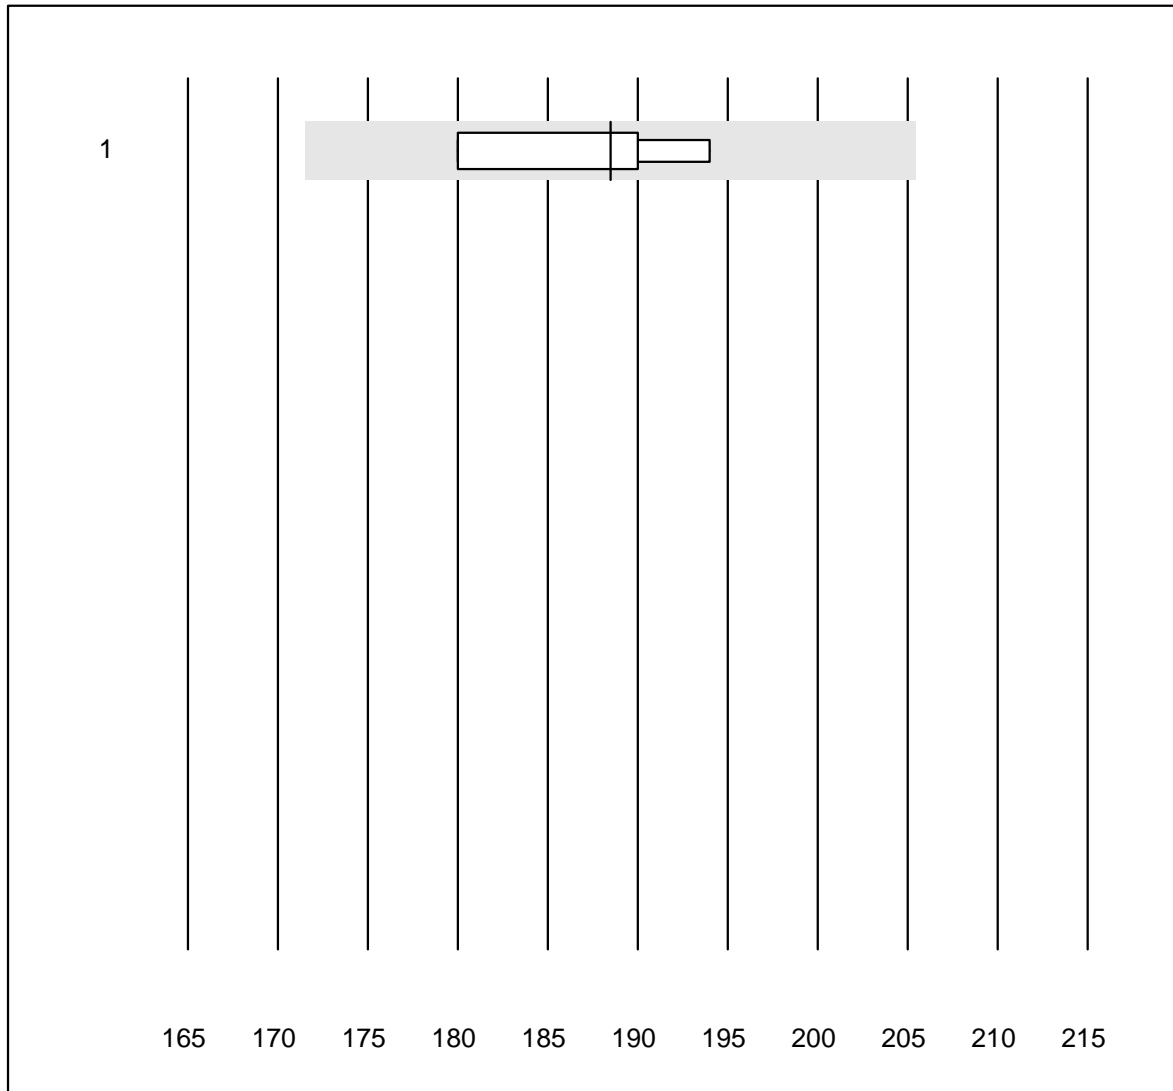


QUALAB Toleranz : 9 %

Hémoglobine BG (g/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 iStat	4	100.0	0.0	0.0	188.5	3.1	e*

Hématocrite

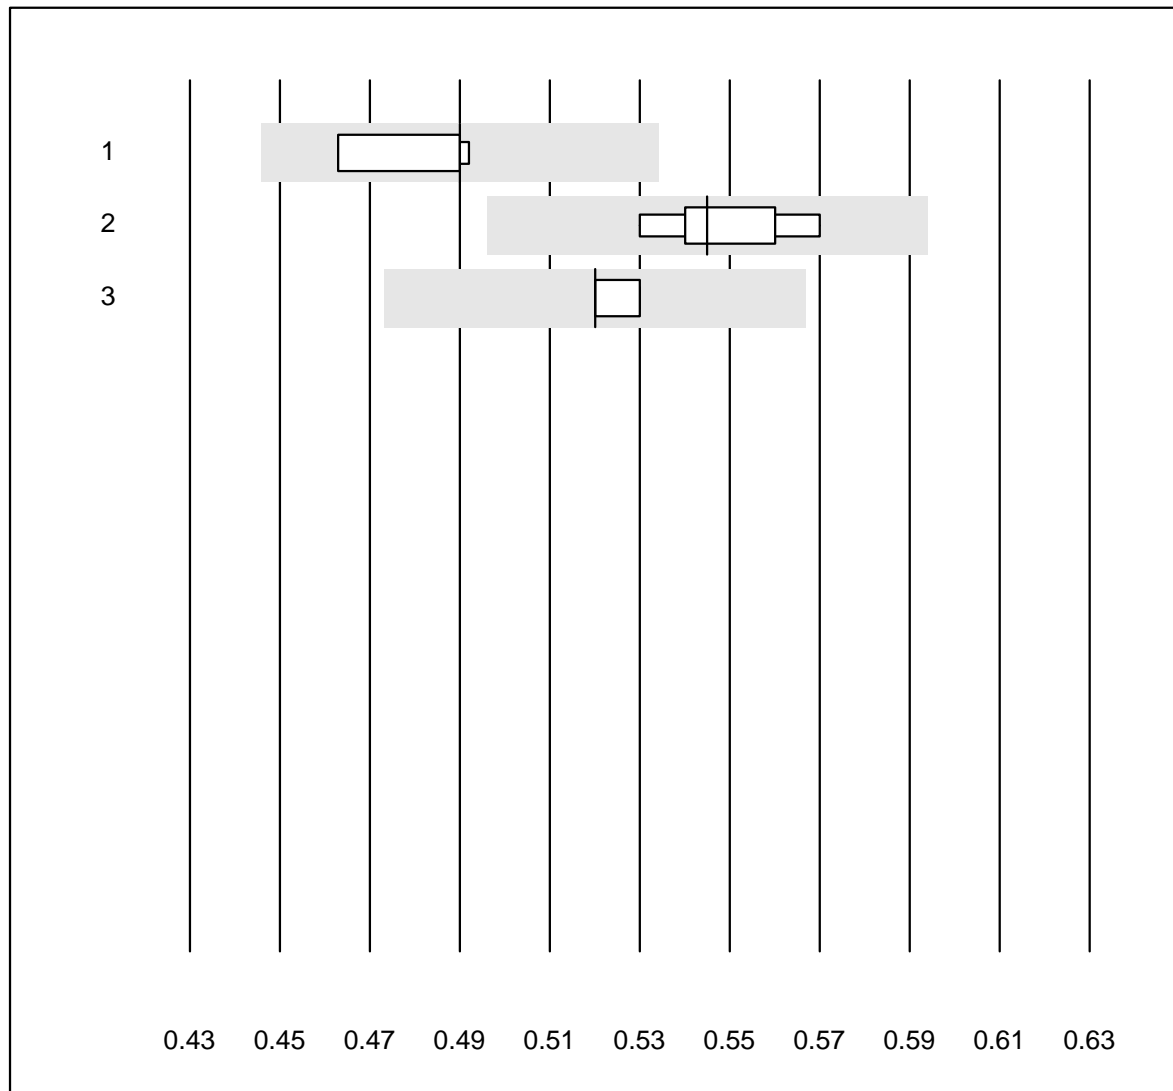


QUALAB Toleranz : 9 %

Hématocrite (l/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas b123	4	100.0	0.0	0.0	0.49	2.9	e*
2 iStat	6	100.0	0.0	0.0	0.55	2.7	e*
3 EPOC	5	60.0	0.0	40.0	0.52	1.1	e

Hémoglobine

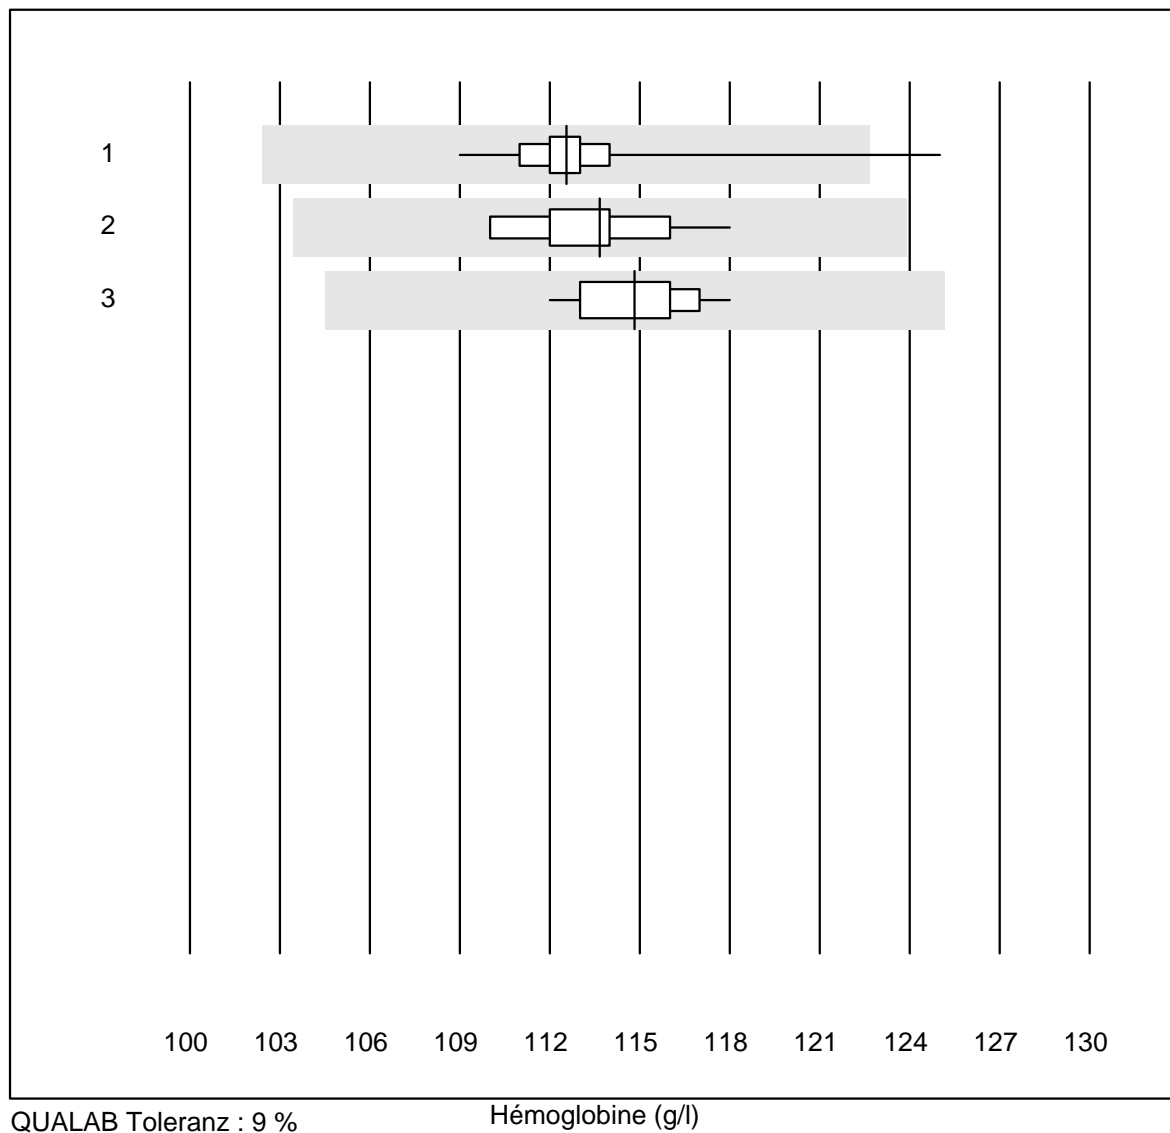

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	54	96.2	1.9	1.9	112.5	2.0	e
2 Advia	12	100.0	0.0	0.0	113.7	2.1	e
3 ABX Pentra	13	92.3	0.0	7.7	114.8	1.7	e

Hématocrite

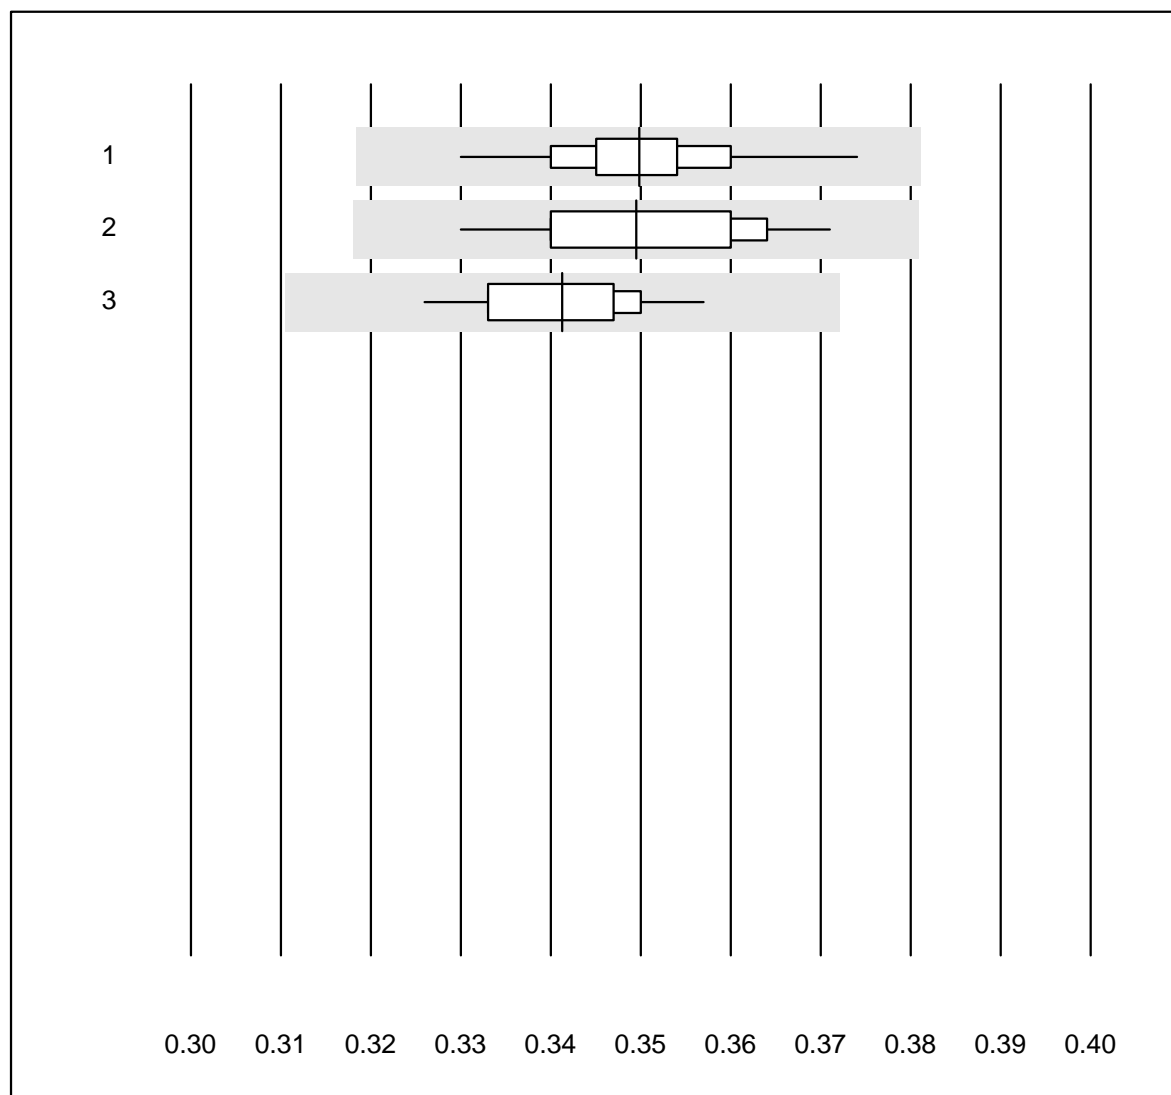


QUALAB Toleranz : 9 %

Hématocrite (l/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	54	98.1	0.0	1.9	0.35	2.5	e
2 Advia	12	100.0	0.0	0.0	0.35	3.5	e
3 ABX Pentra	13	92.3	0.0	7.7	0.34	2.6	e

Erythrocytes

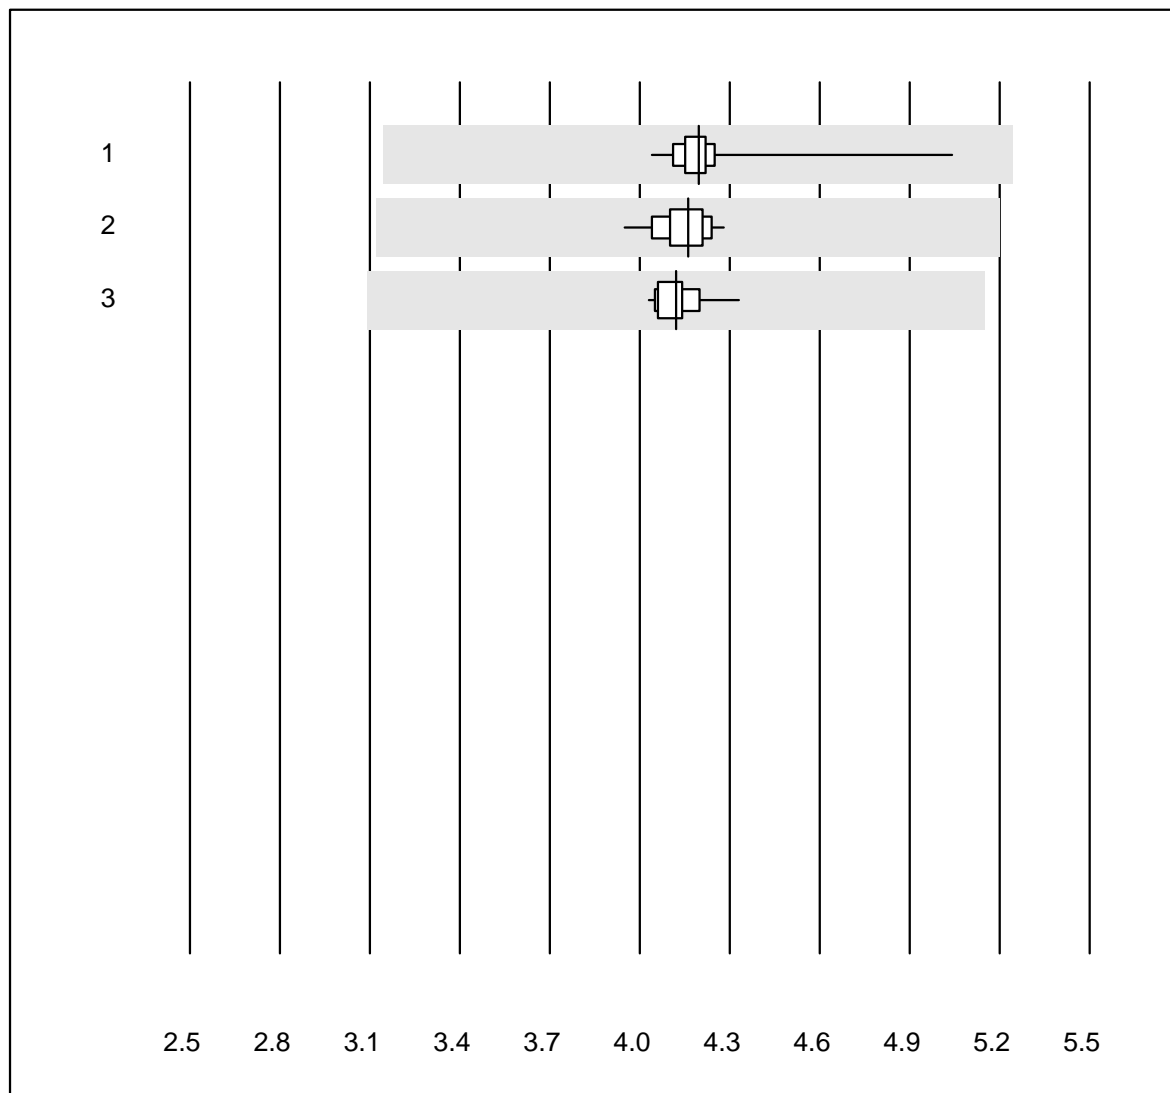


QUALAB Toleranz : 25 %

Erythrocytes (T/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex	54	100.0	0.0	0.0	4.20	3.1	e
2	Advia	12	100.0	0.0	0.0	4.16	2.2	e
3	ABX Pentra	13	92.3	0.0	7.7	4.12	2.0	e

Leucocytes

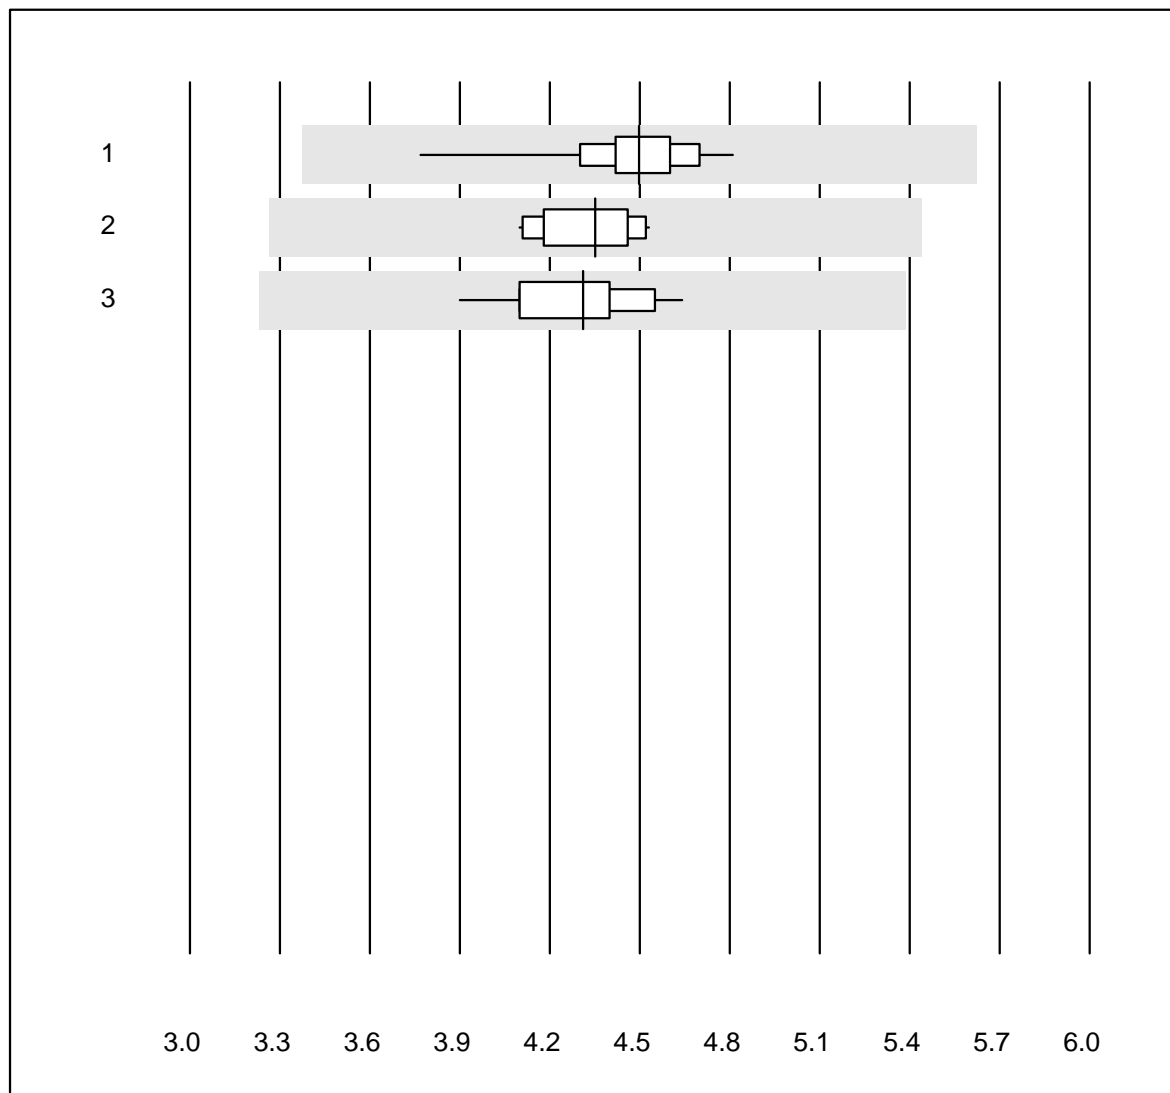


QUALAB Toleranz : 25 %

Leucocytes (G/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	54	98.1	0.0	1.9	4.50	3.8	e
2 Advia	12	100.0	0.0	0.0	4.35	3.6	e
3 ABX Pentra	13	92.3	0.0	7.7	4.31	4.8	e

Thrombocytes

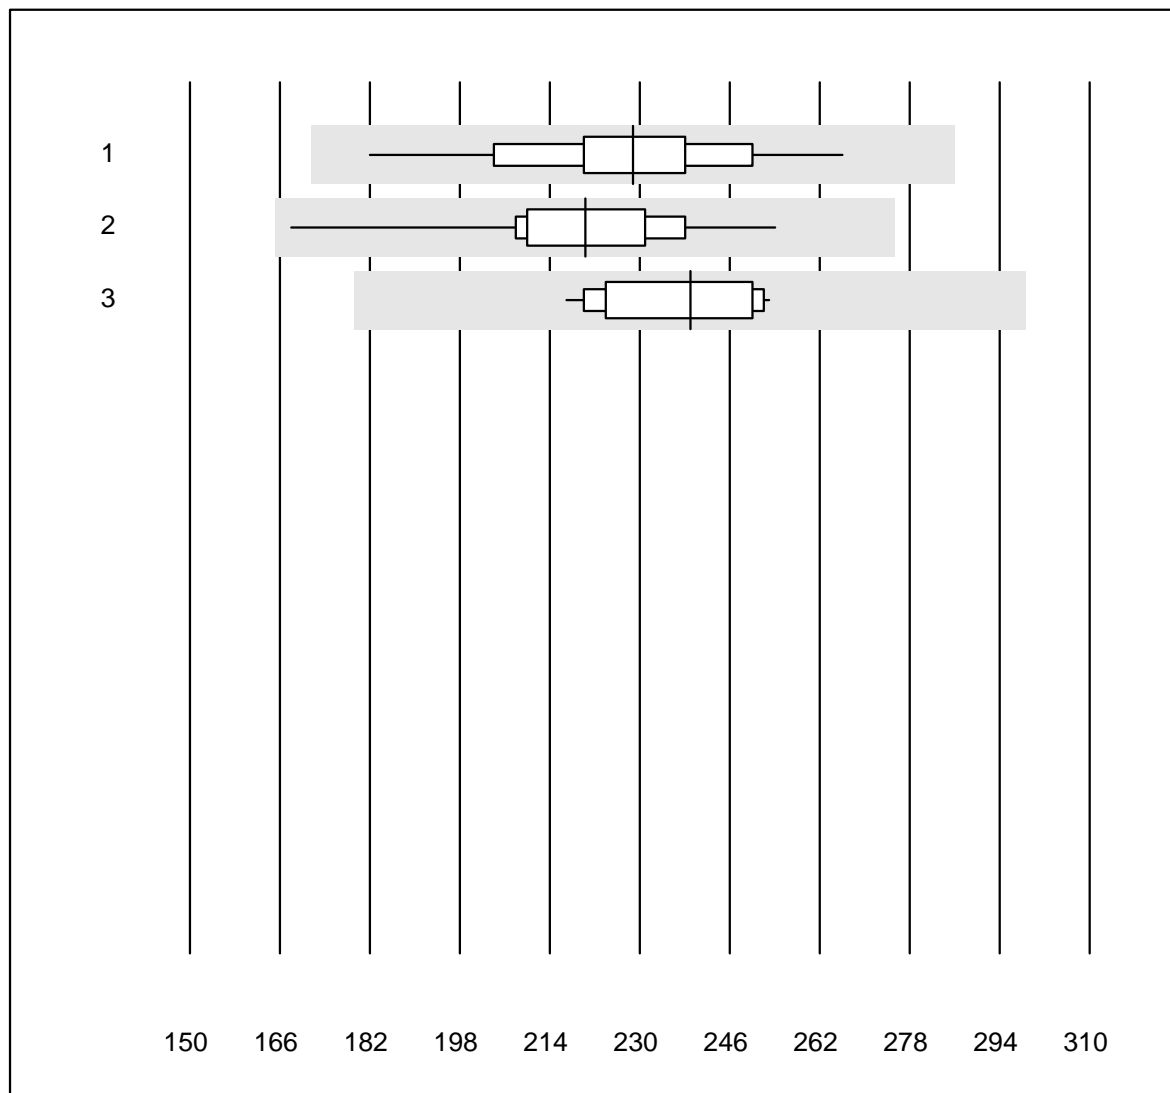


QUALAB Toleranz : 25 %

Thrombocytes (G/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	54	100.0	0.0	0.0	228.9	7.8	e
2 Advia	12	100.0	0.0	0.0	220.3	9.6	e
3 ABX Pentra	13	92.3	0.0	7.7	239.0	5.4	e

Neutrophiles

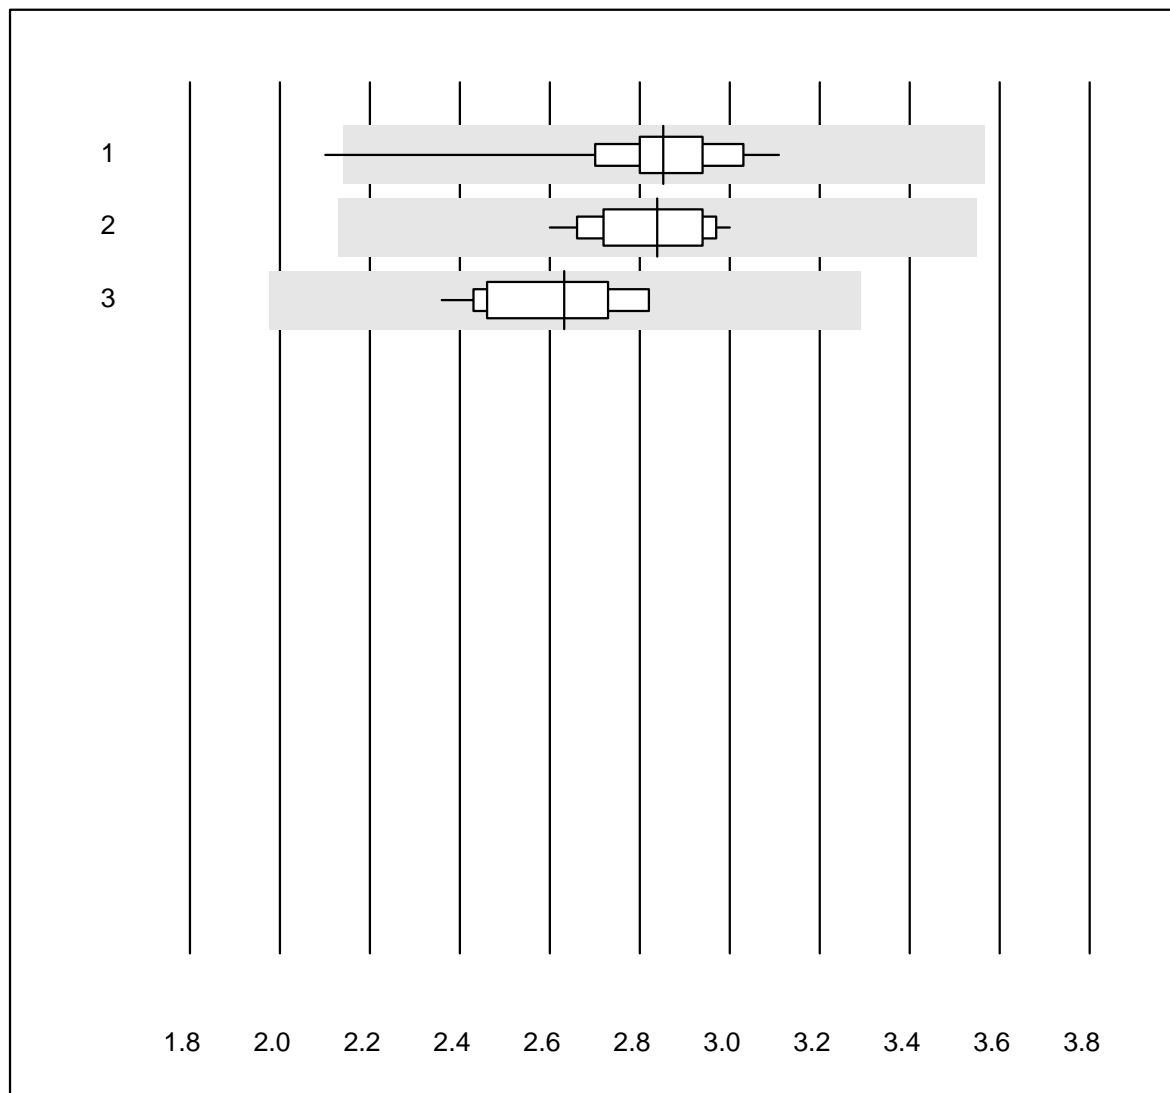


Tolérance MQ : 25 %

Neutrophiles (G/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	54	98.1	1.9	0.0	2.85	6.1	e
2 Advia	12	100.0	0.0	0.0	2.84	4.6	e
3 ABX Pentra	13	92.3	0.0	7.7	2.63	6.0	e

Lymphocytes

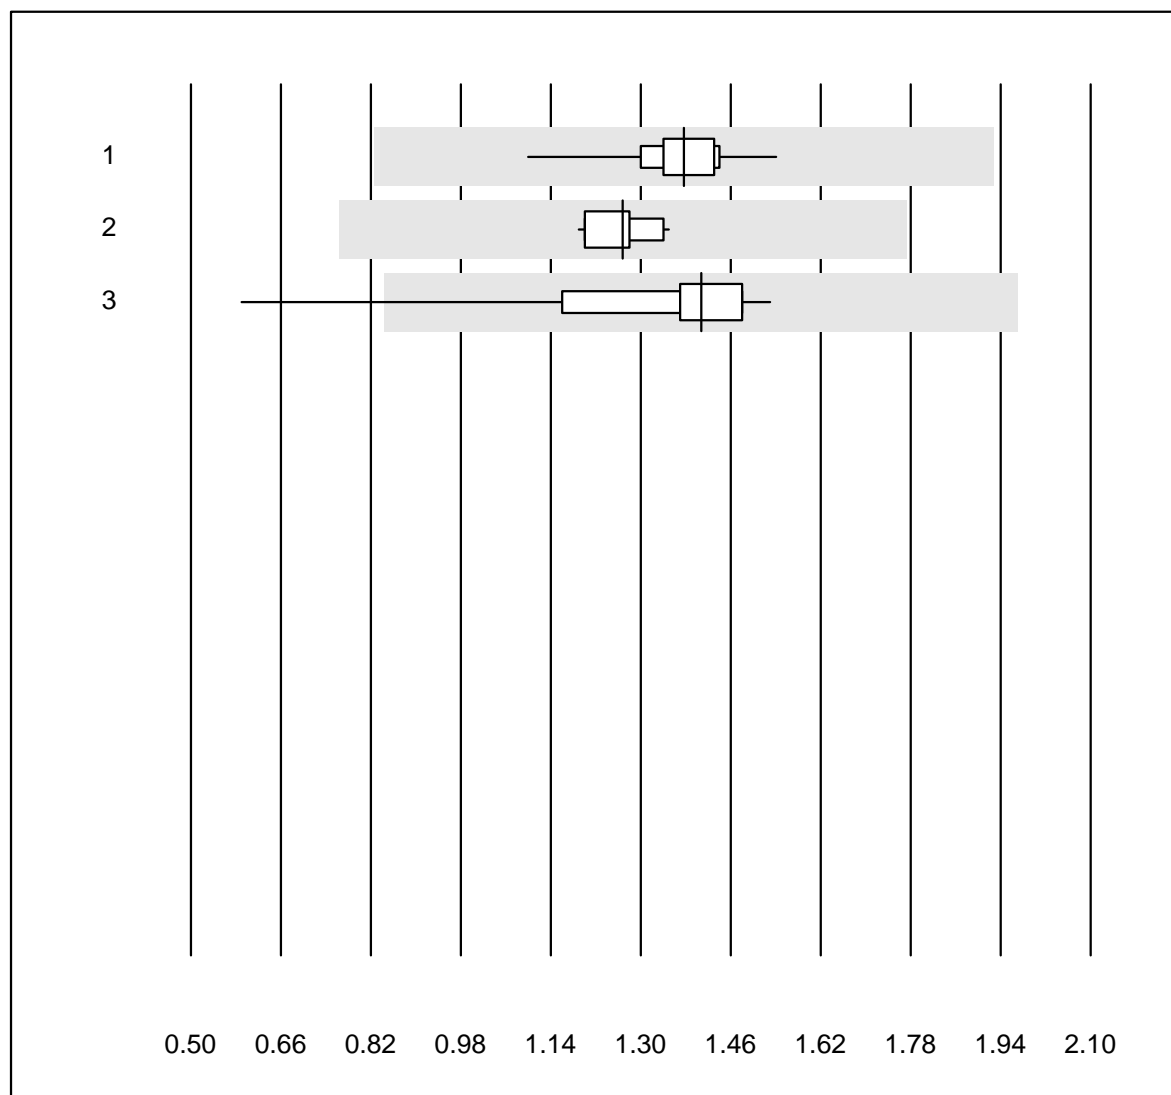


Tolérance MQ : 25 %

Lymphocytes (G/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex	54	100.0	0.0	0.0	1.38	4.9	a
2	Advia	12	100.0	0.0	0.0	1.27	4.0	a
3	ABX Pentra	13	92.3	7.7	0.0	1.41	18.3	a

Monocytes

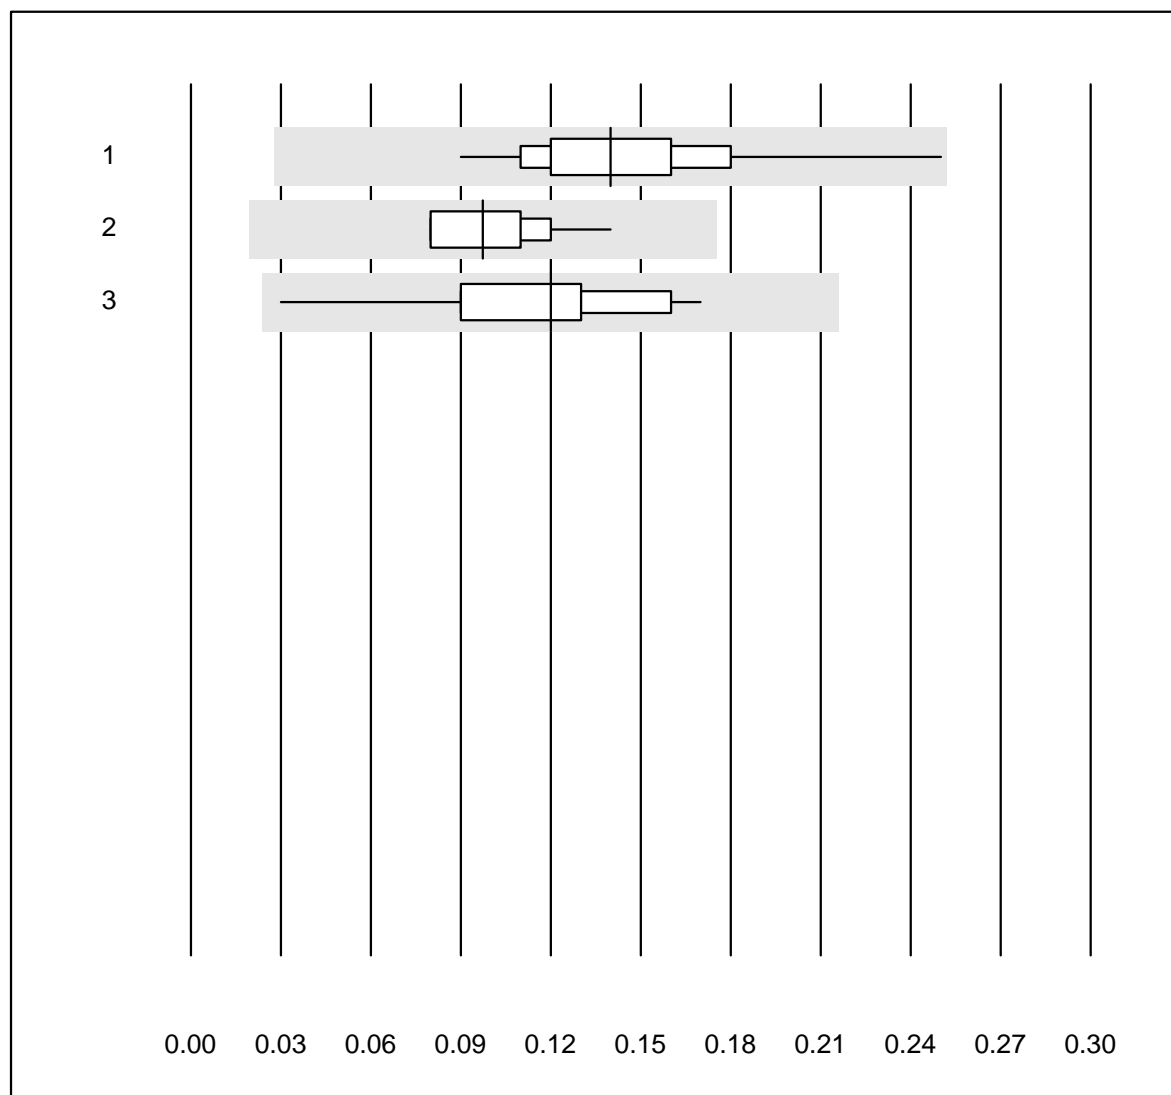


Tolérance MQ : 25 %

Monocytes (G/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	54	100.0	0.0	0.0	0.14	21.6	a
2 Advia	12	100.0	0.0	0.0	0.10	17.7	a
3 ABX Pentra	13	92.3	0.0	7.7	0.12	31.3	a

Eosinophiles

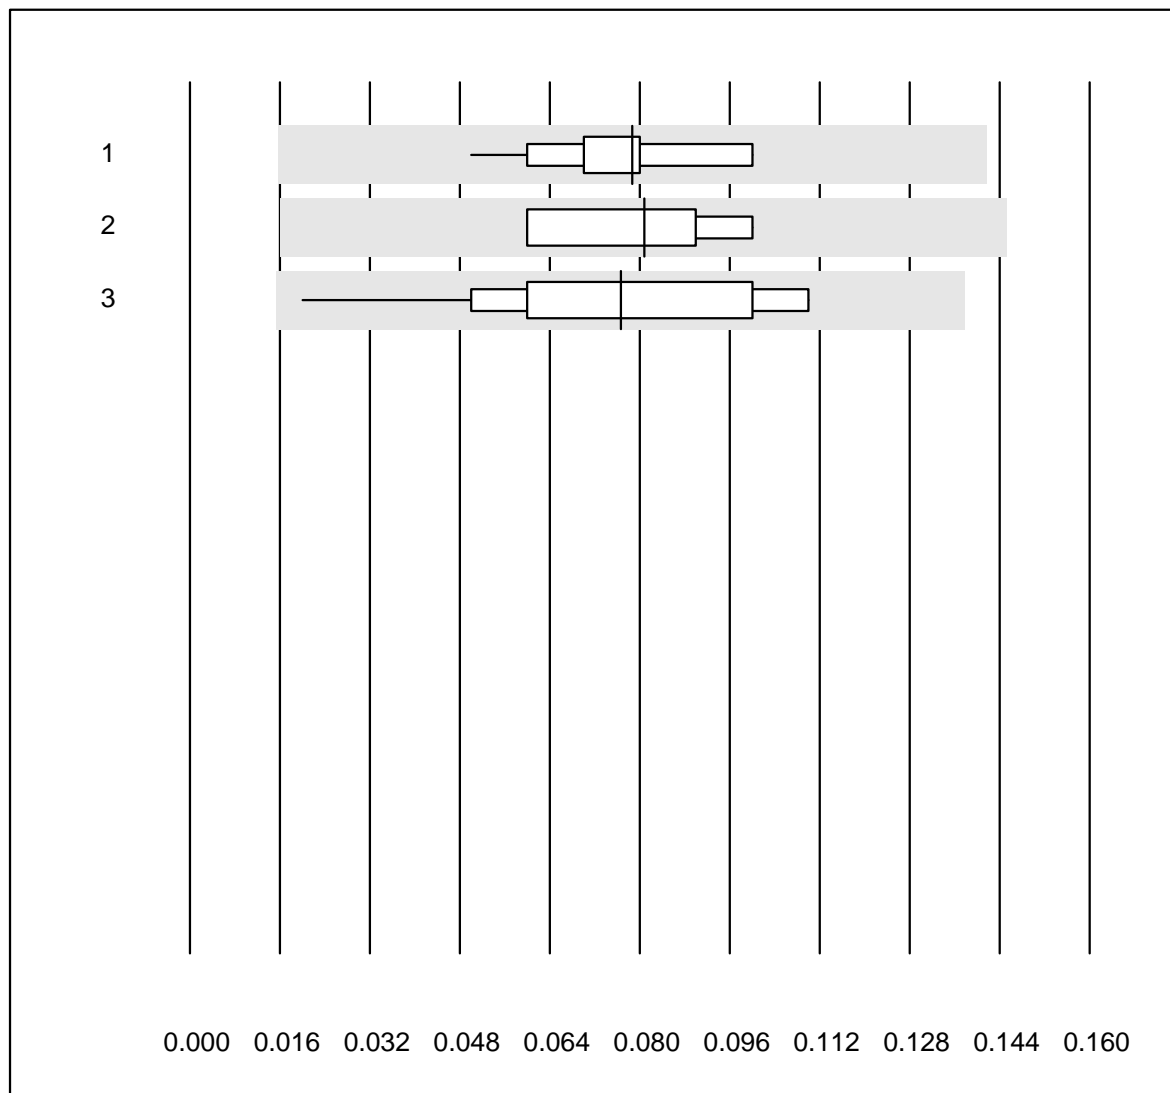


Tolérance MQ : 50 %

Eosinophiles (G/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	54	100.0	0.0	0.0	0.08	16.4	a
2 Advia	12	100.0	0.0	0.0	0.08	20.1	a
3 ABX Pentra	13	100.0	0.0	0.0	0.08	35.1	a

Basophiles

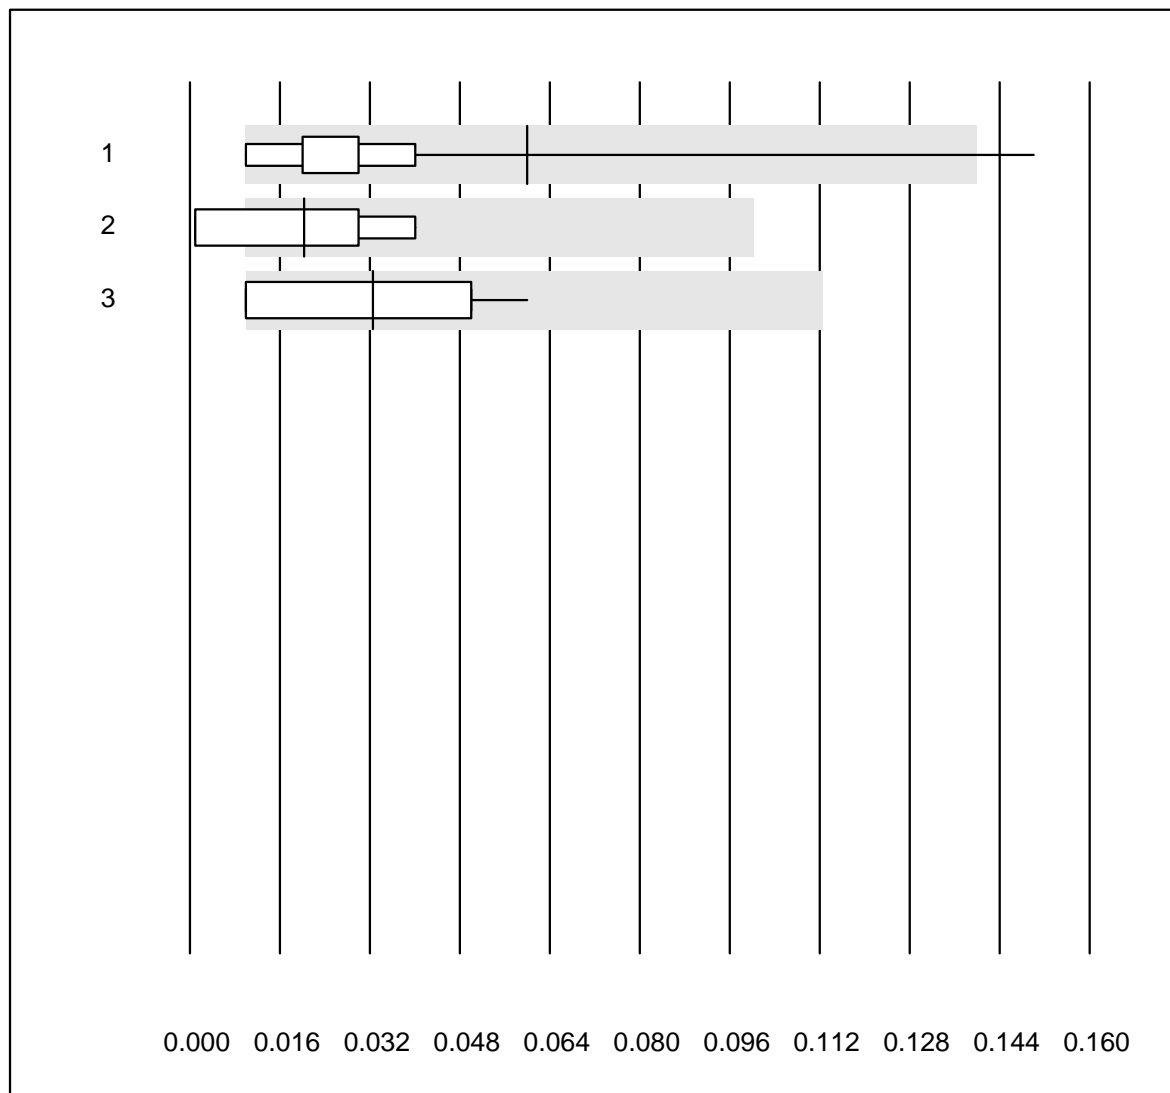


Tolérance MQ : 80 %
 (< 0.10: +/- 0.08 G/l)

Basophiles (G/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	53	98.1	1.9	0.0	0.06	90.3	a
2 Advia	11	100.0	0.0	0.0	0.02	71.2	e*
3 ABX Pentra	12	100.0	0.0	0.0	0.03	55.9	e*

Réticulocytes

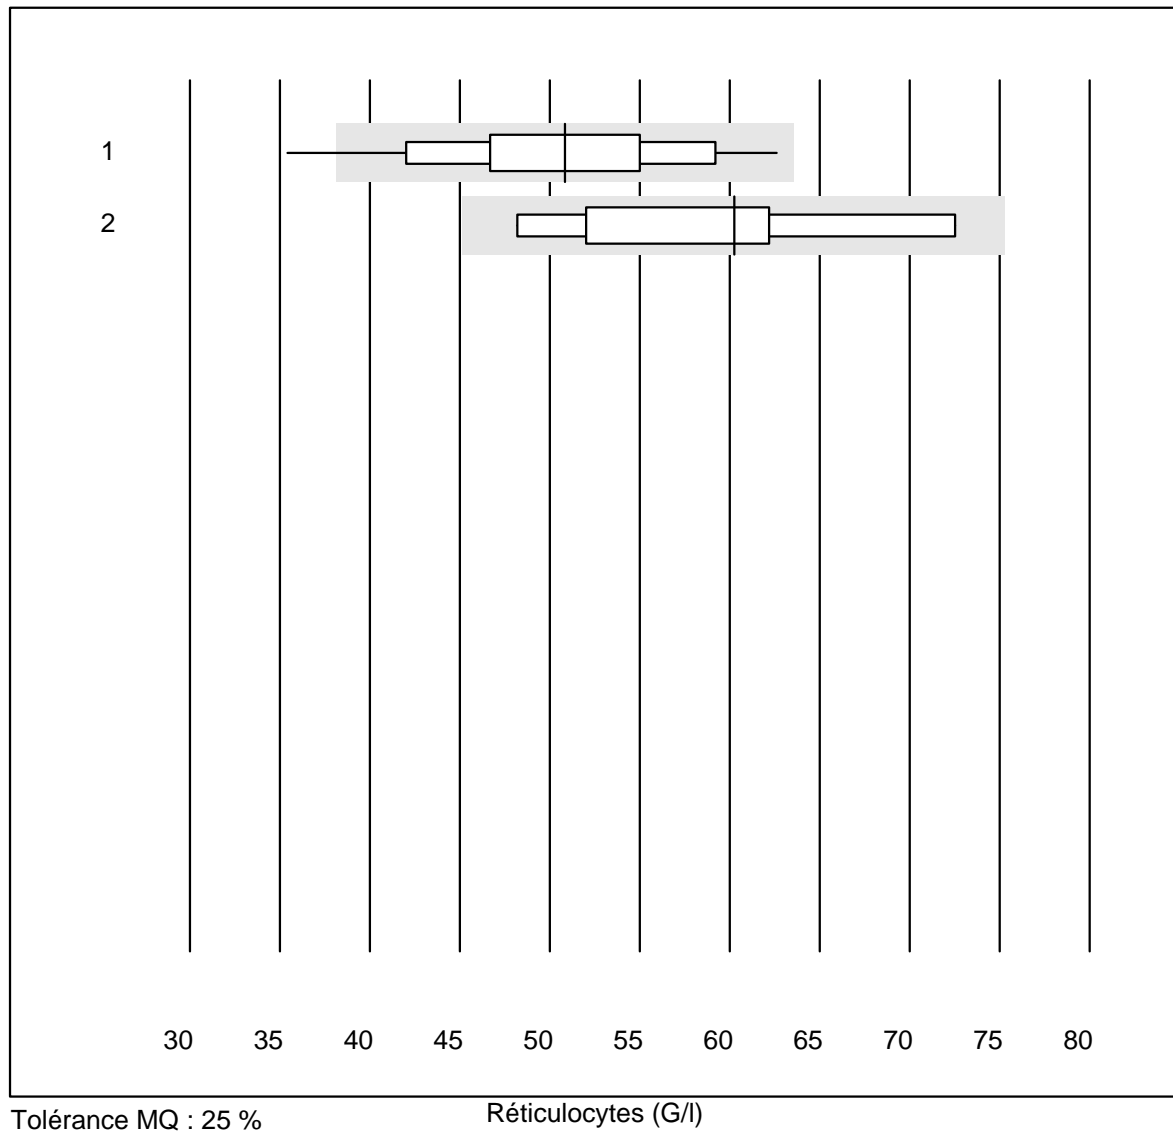

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	29	96.6	3.4	0.0	50.8	12.4	e
2 Advia	9	100.0	0.0	0.0	60.3	15.8	a

Index hémolytique échantillon A

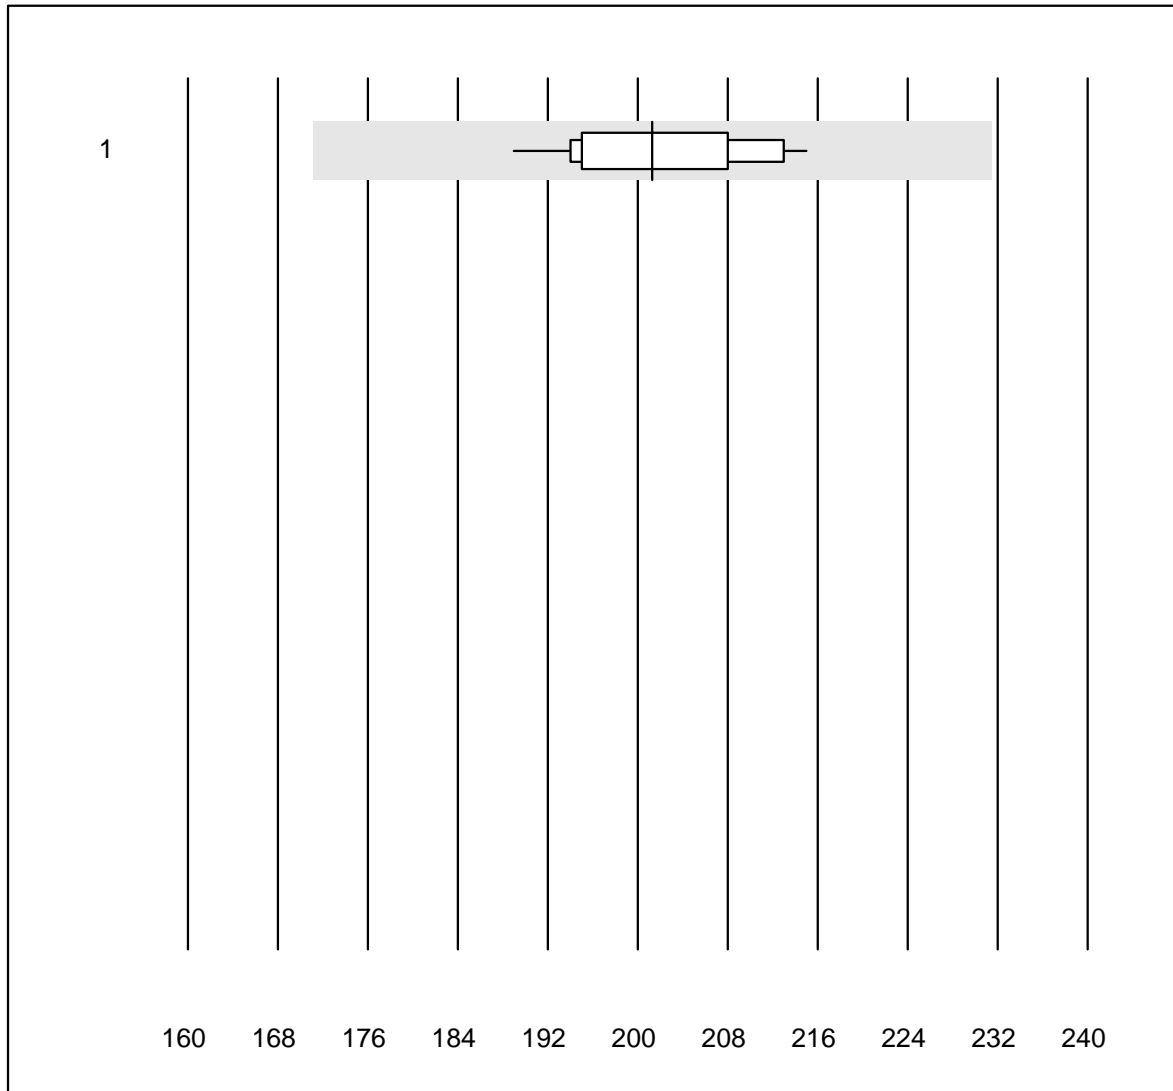


Tolérance MQ : 15 %

Index hémolytique échantillon A ()

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	15	100.0	0.0	0.0	201.27	3.9	e

Index hémolytique échantillon B

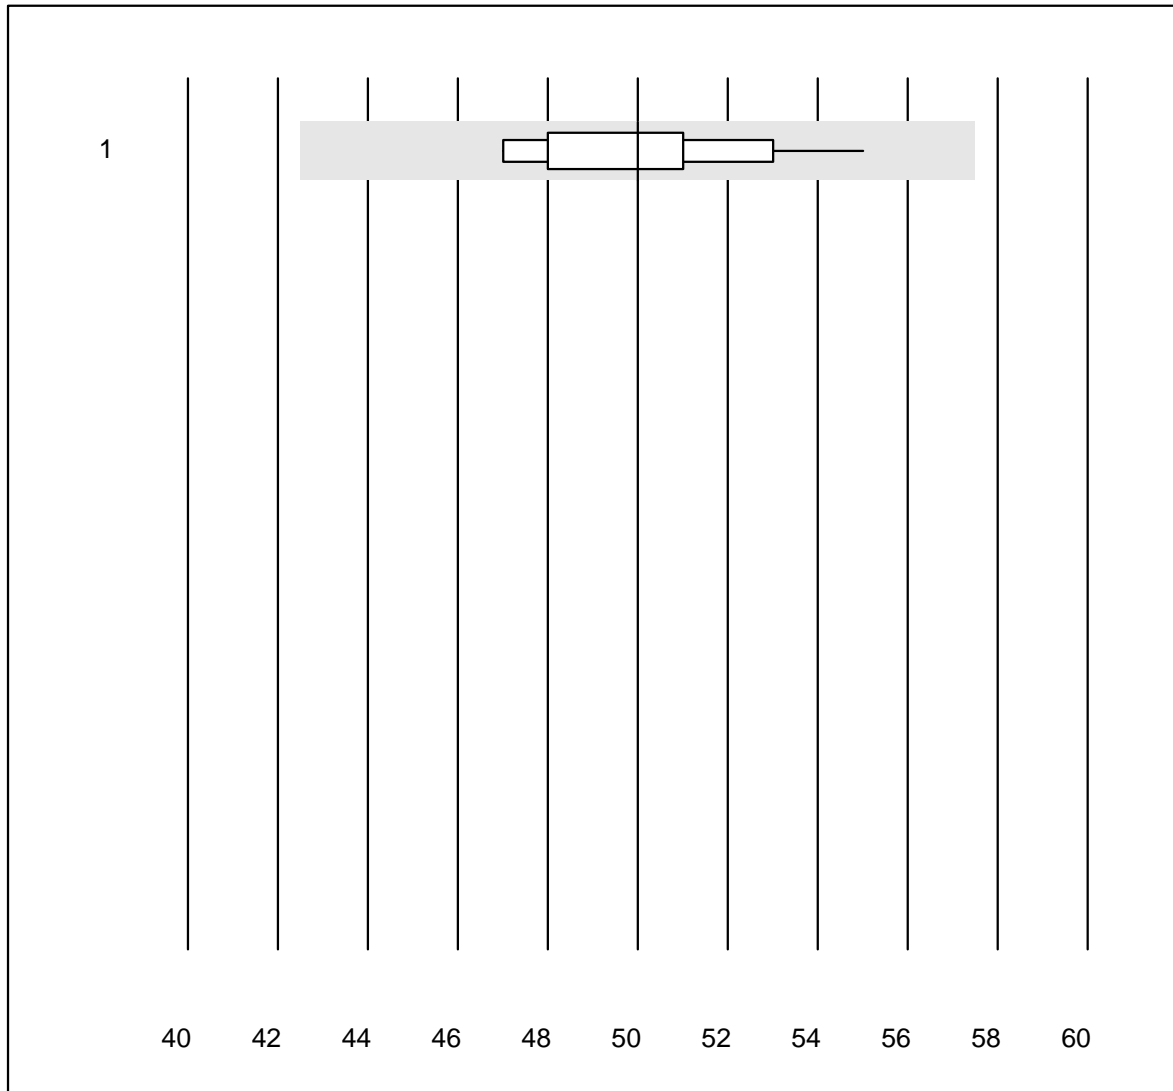


Tolérance MQ : 15 %

Index hémolytique échantillon B ()

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	15	100.0	0.0	0.0	50.00	4.5	e

Vitesse de sédimentation 1h

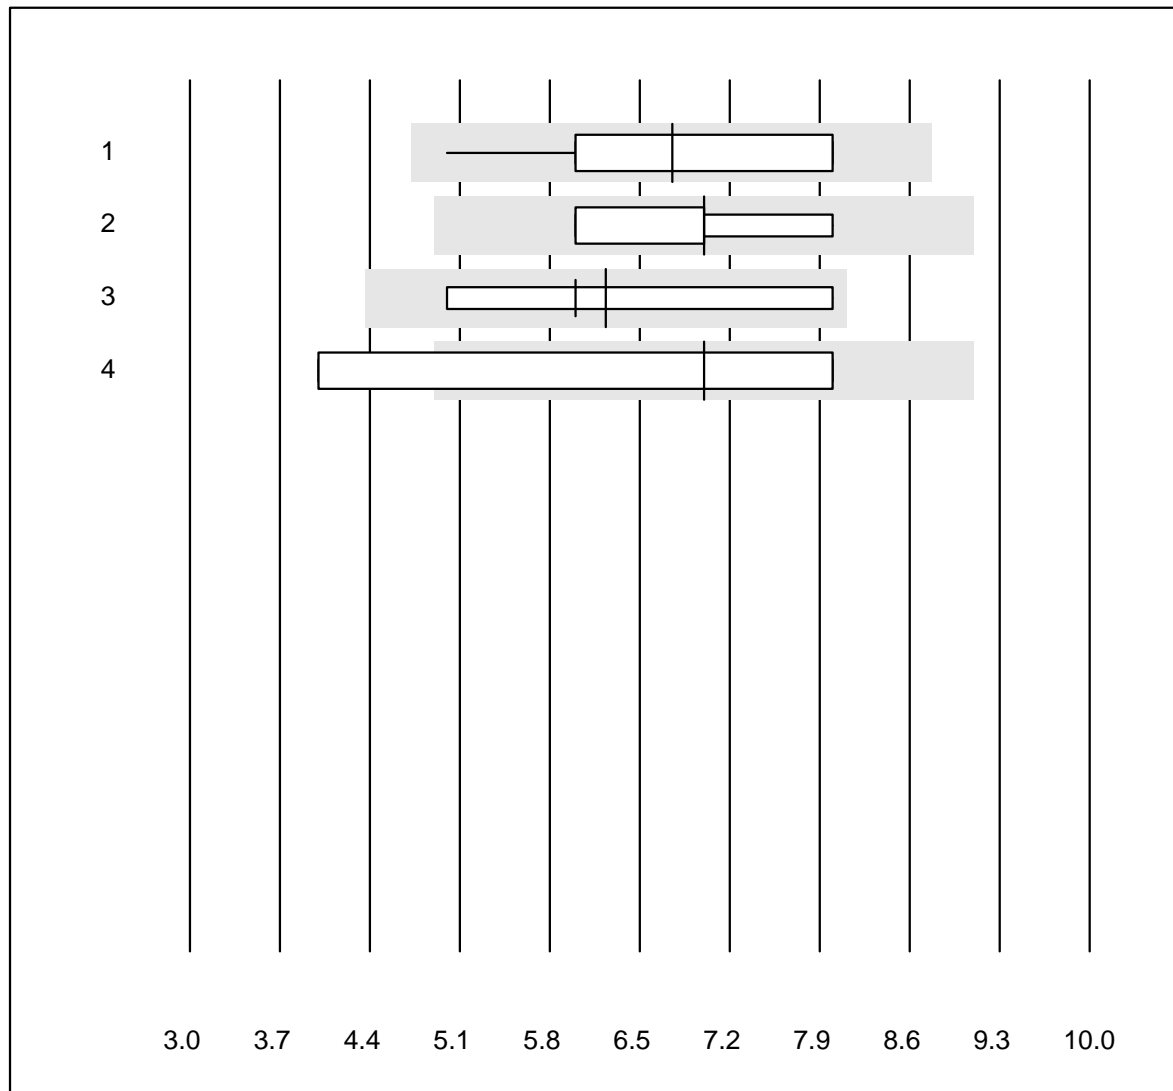


Tolérance MQ : 30 %

Vitesse de sédimentation 1h (mm/h)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sarstedt Sedivette	16	100.0	0.0	0.0	7	14.8	e*
2	Sarstedt Microvette	6	100.0	0.0	0.0	7	11.0	e*
3	BD Seditainer	21	100.0	0.0	0.0	6	16.0	e
4	Autres méthodes	4	75.0	25.0	0.0	7	29.5	e*

Vitesse de sédimentation 2h

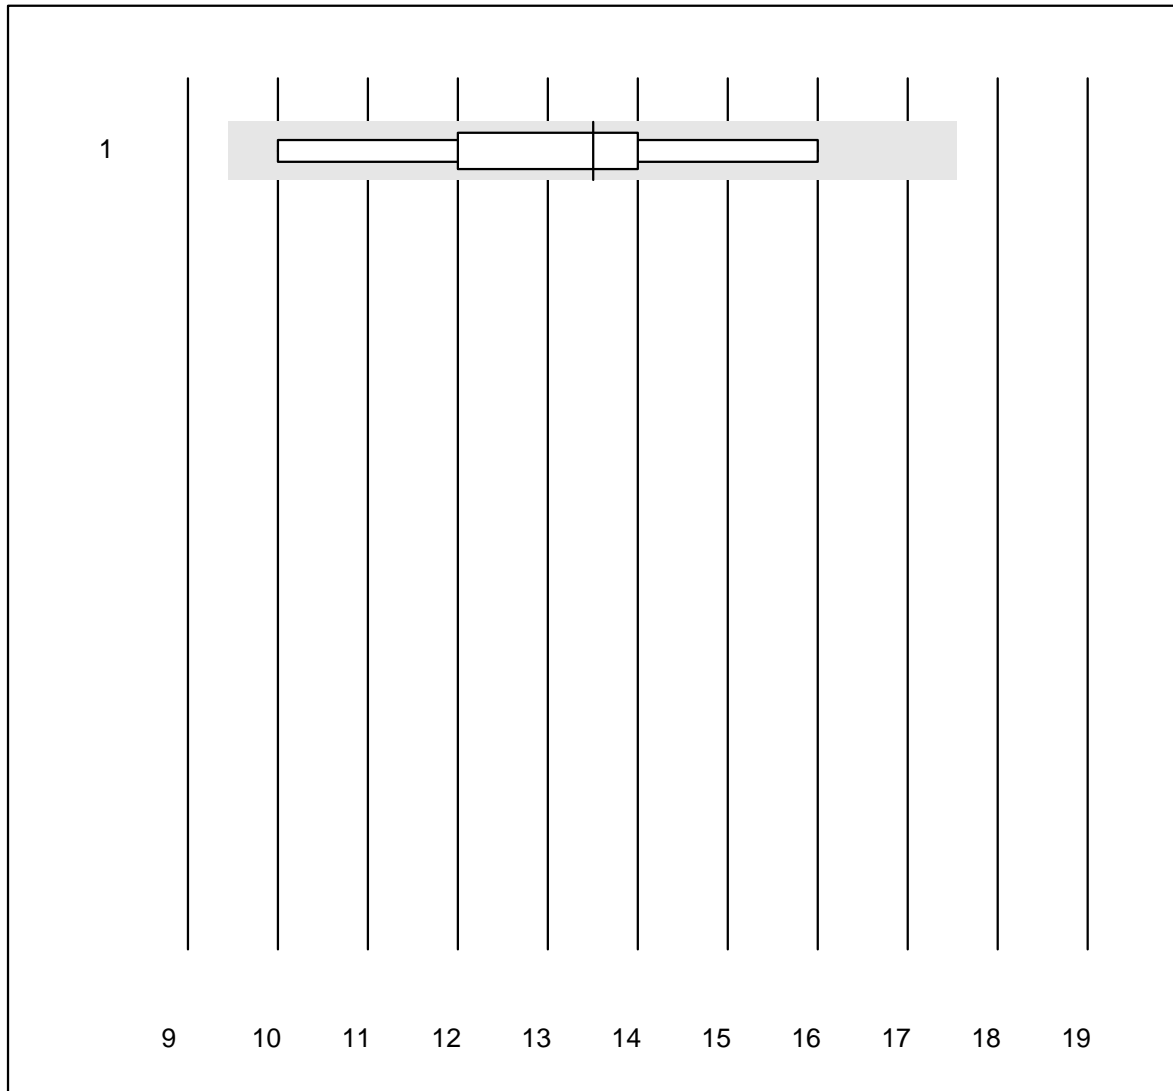


Tolérance MQ : 30 %

Vitesse de sédimentation 2h (mm/2h)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	BD Seditainer	6	100.0	0.0	0.0	14	15.5	e*

CRP

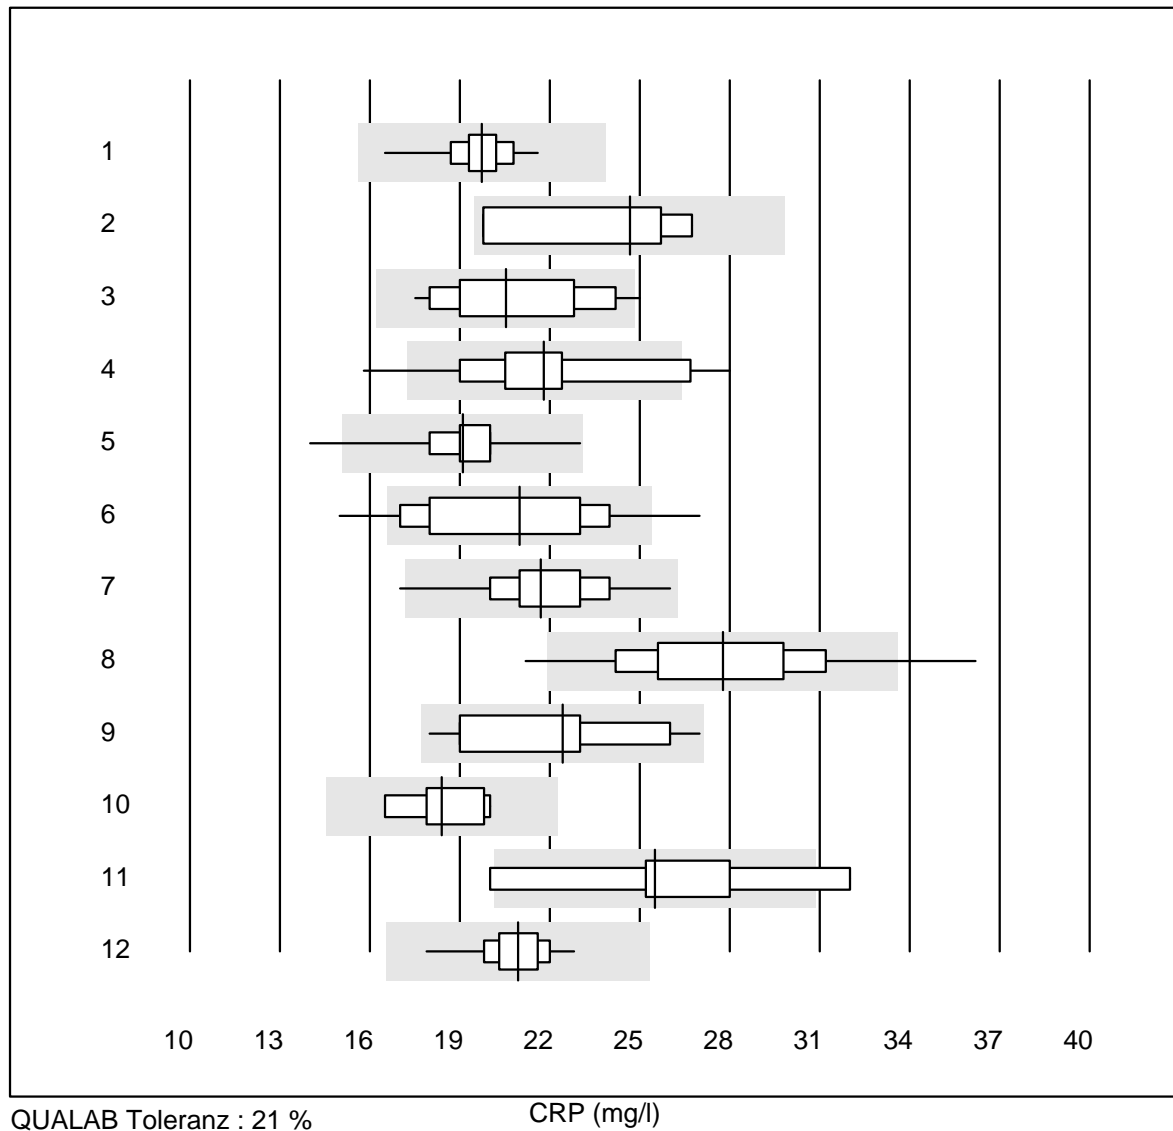


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas b101	157	99.4	0.0	0.6	19.7	3.9	e
2	IChroma	4	100.0	0.0	0.0	24.7	12.8	e*
3	Cobas	19	89.4	5.3	5.3	20.5	12.3	e*
4	Turbidimetrie	20	80.0	15.0	5.0	21.8	11.8	e*
5	Afinion	1321	99.6	0.2	0.2	19.1	5.0	e
6	NycoCard SingleTest-	180	79.5	11.1	9.4	21.0	13.8	e
7	Quick Read go	108	99.1	0.9	0.0	21.7	7.2	e
8	Eurolyser	113	77.0	4.4	18.6	27.8	10.8	e
9	Fuji Dri-Chem	15	80.0	0.0	20.0	22.4	12.8	e*
10	Autolyser/DiaSys	10	100.0	0.0	0.0	18.4	6.5	e
11	Piccolo	7	71.4	28.6	0.0	25.5	13.9	e*
12	Celltac chemi	36	100.0	0.0	0.0	21.0	5.0	e

CRP

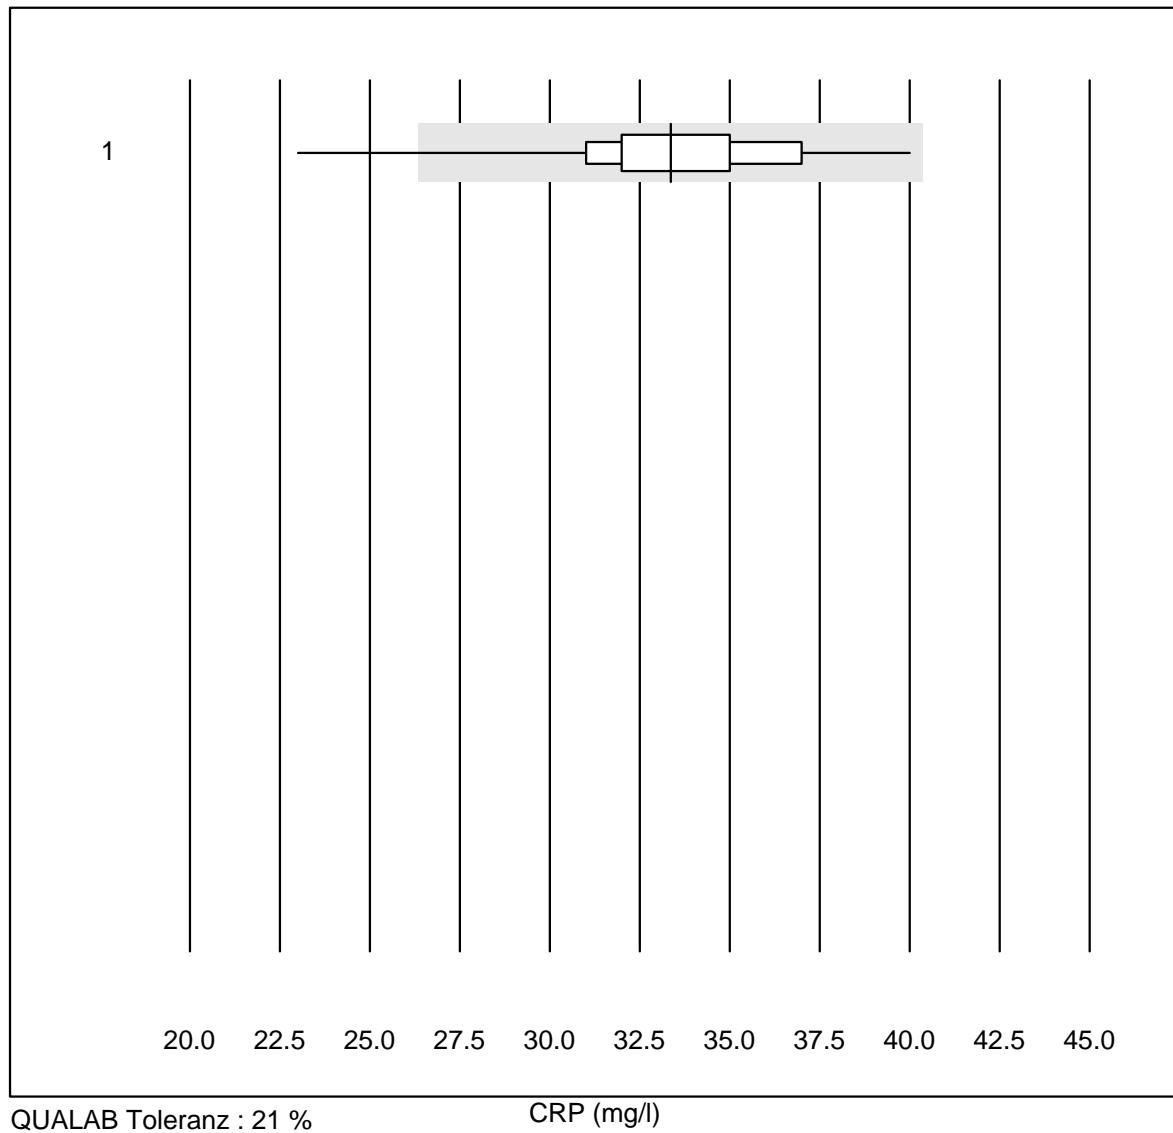


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	QuickRead (sang comp	69	94.3	4.3	1.4	33.4	9.3	e

CRP

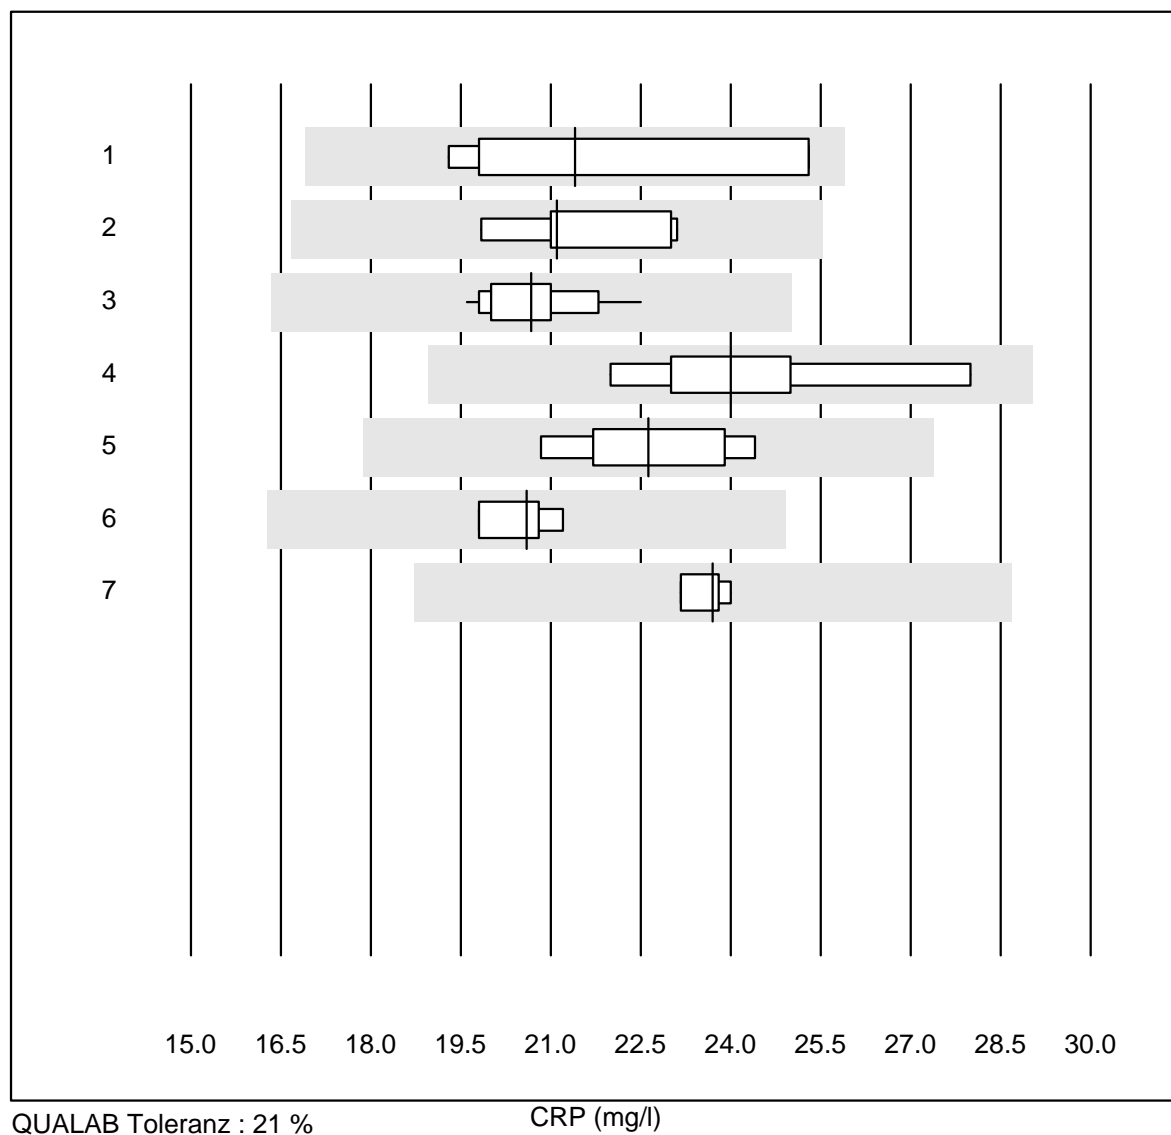

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Spinit	8	87.5	0.0	12.5	21.4	11.7	e*
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	21.1	6.5	e*
3 Beckman	11	100.0	0.0	0.0	20.7	4.1	e
4 AQT 90 FLEX	6	100.0	0.0	0.0	24.0	8.9	e*
5 Spotchem D-Concept	6	100.0	0.0	0.0	22.6	5.9	e
6 Spotchem SI-3510	4	100.0	0.0	0.0	20.6	2.9	e
7 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	23.7	1.5	e

IgG

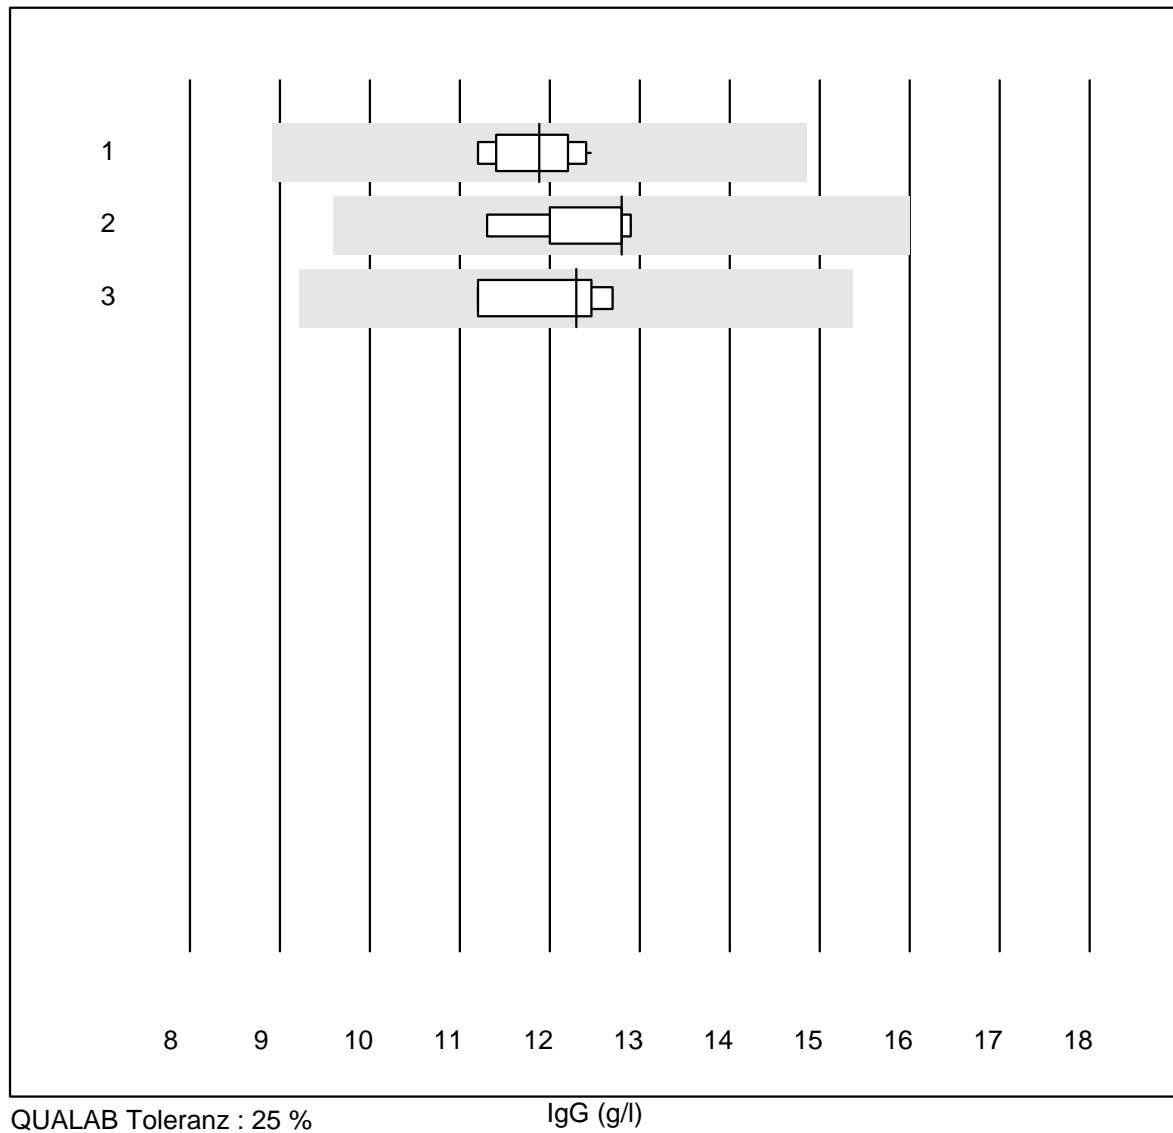


QUALAB Toleranz : 25 %

IgG (g/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Turbidimetrie	13	100.0	0.0	0.0	11.9	4.0	e
2	Nephelometrie	5	100.0	0.0	0.0	12.8	5.6	e
3	Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	12.3	5.4	e

IgA

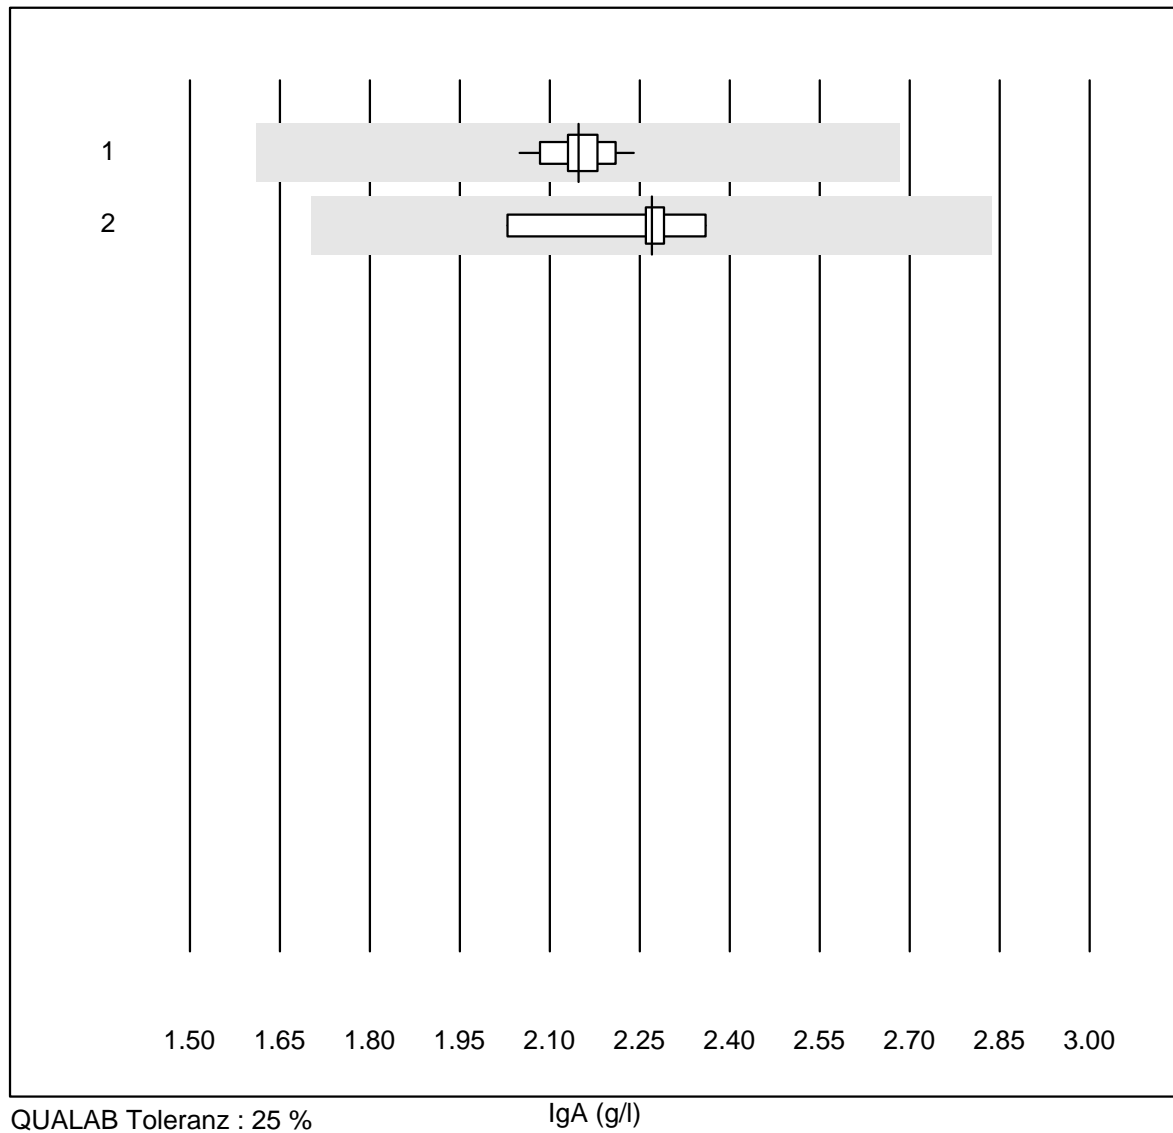


QUALAB Toleranz : 25 %

IgA (g/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Turbidimetrie	14	100.0	0.0	0.0	2.1	2.3	e
2	Nephelometrie	5	100.0	0.0	0.0	2.3	5.6	e

IgM

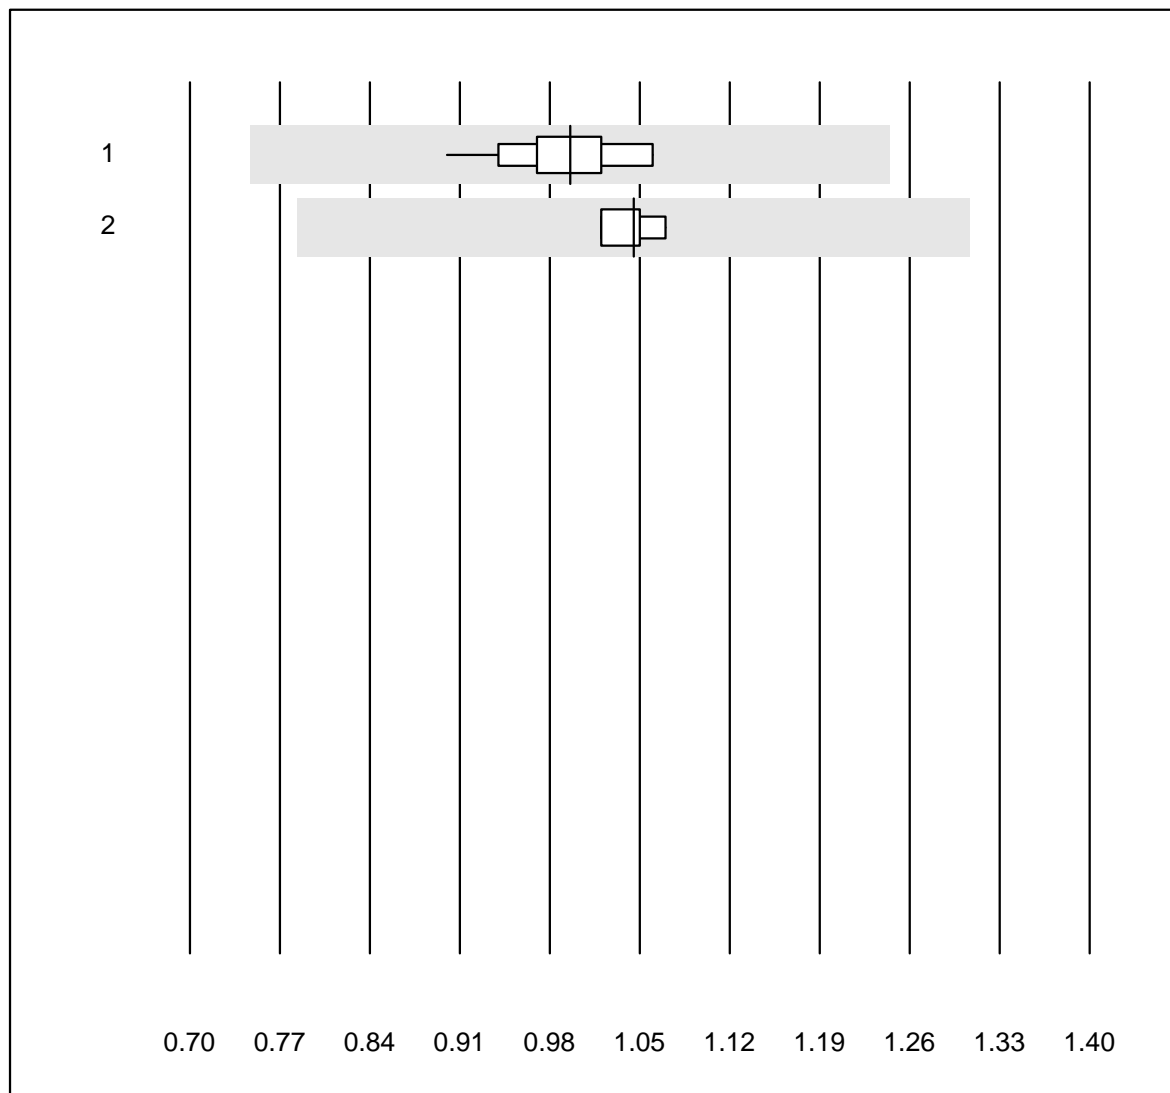


QUALAB Toleranz : 25 %

IgM (g/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Turbidimetrie	15	100.0	0.0	0.0	1.0	4.5	e
2 Nephelometrie	4	100.0	0.0	0.0	1.0	2.0	e

IgE

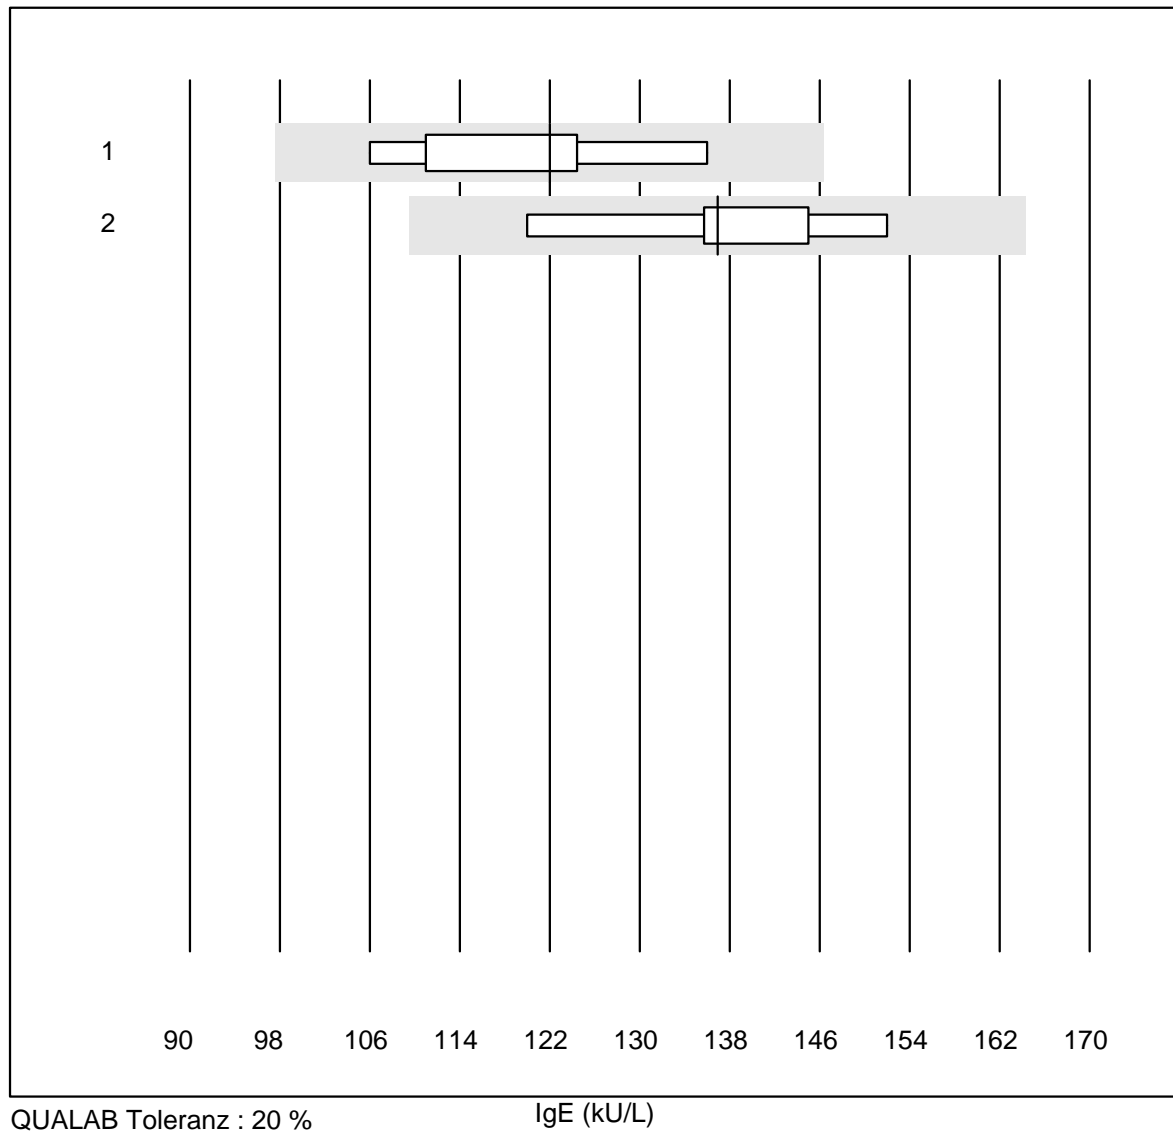


QUALAB Toleranz : 20 %

IgE (kU/L)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	122	9.8	e*
2 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	137	8.7	e*

Alpha-1-Antitrypsine

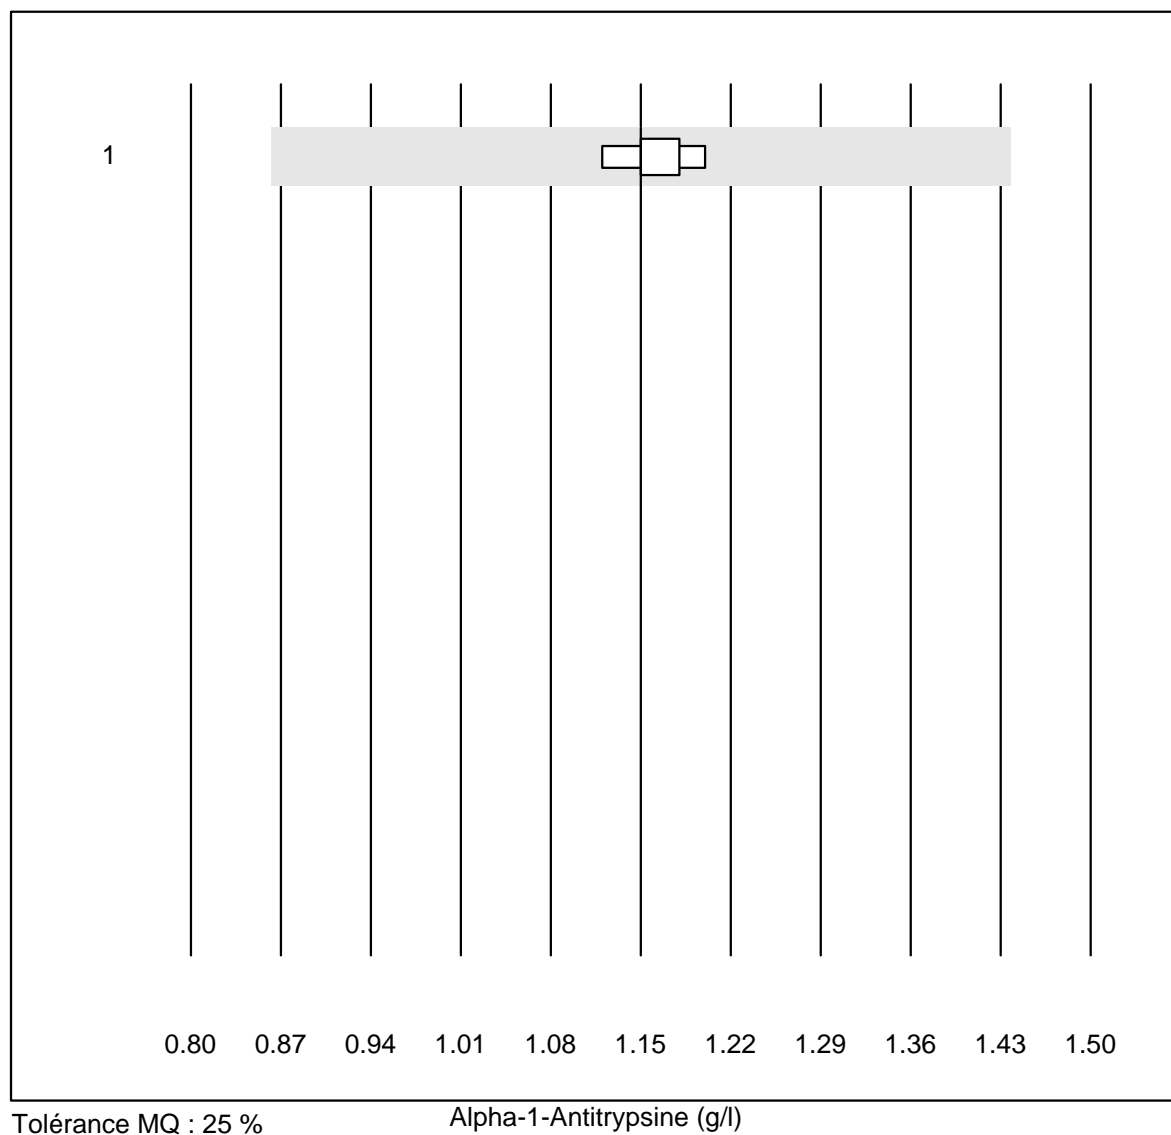

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	1.15	2.4	e

Anti-Streptolysine-Anticorps

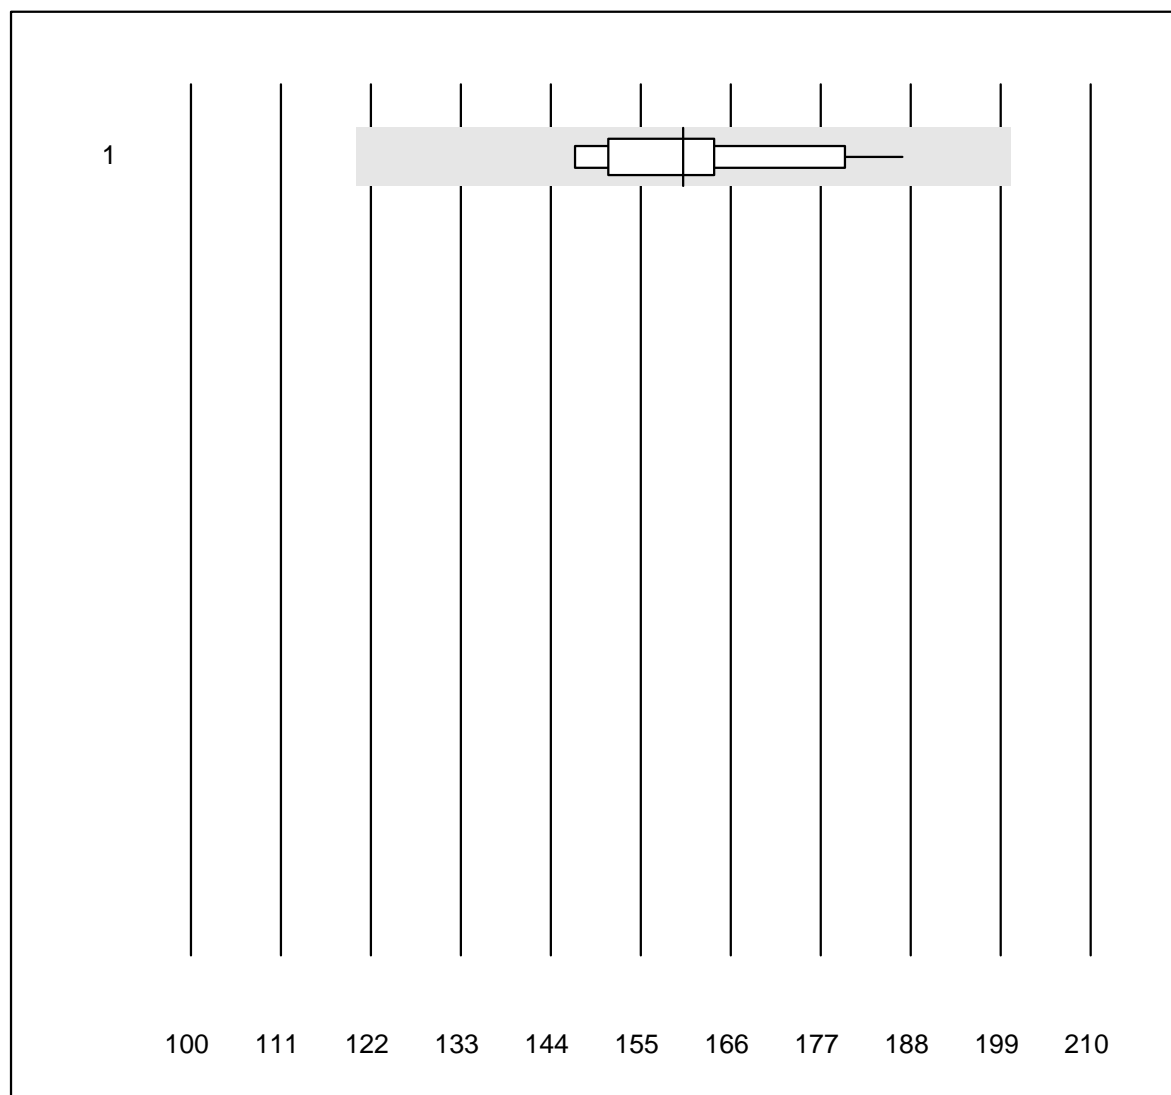


Tolérance MQ : 25 %

Anti-Streptolysine-Anticorps (kIU/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	11	100.0	0.0	0.0	160	8.1	e

Complément C3

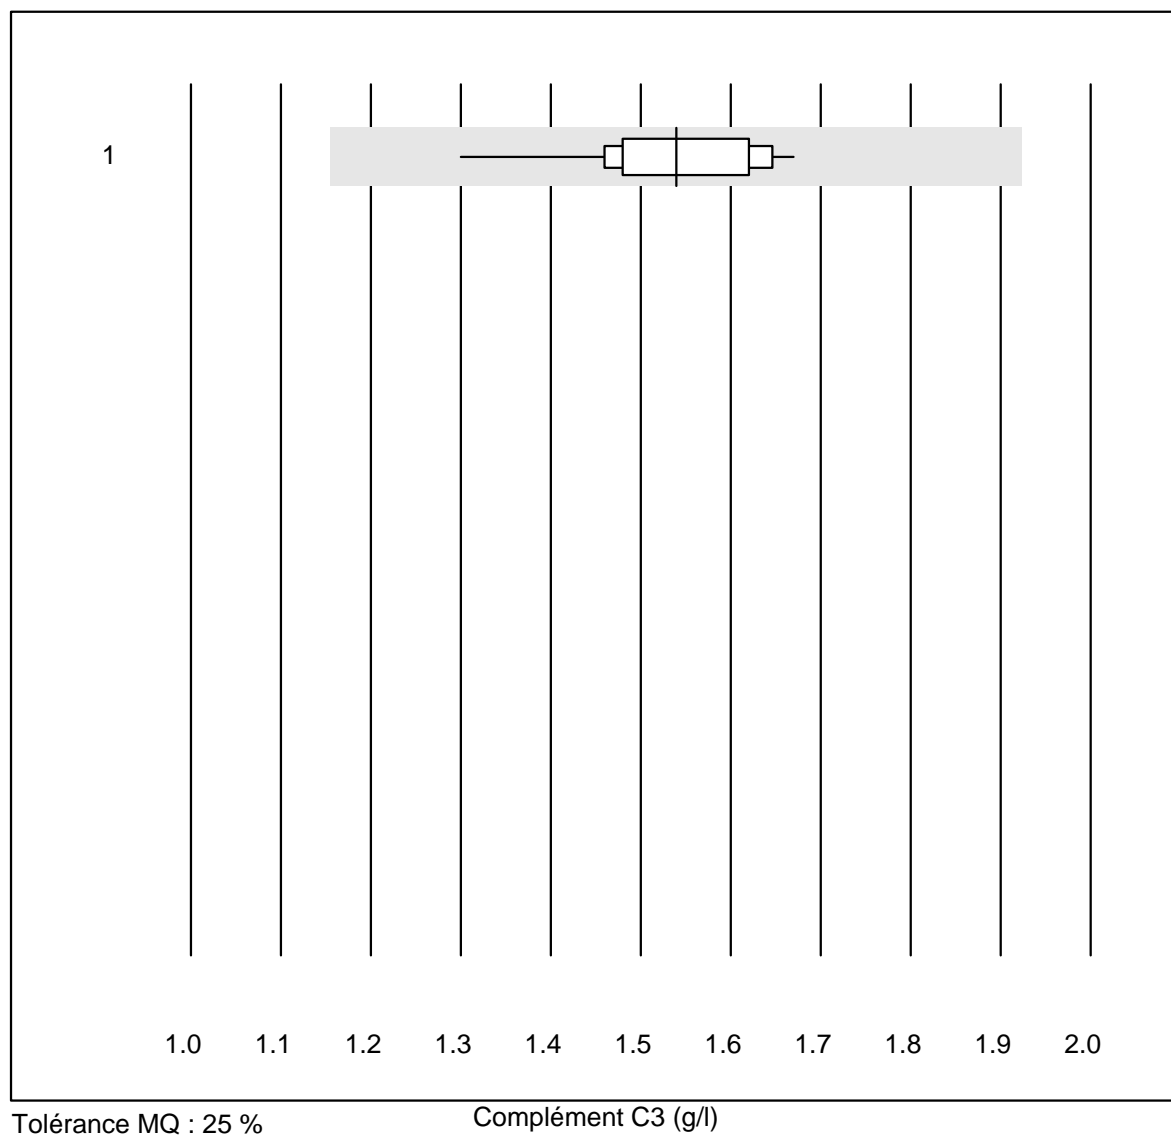


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	15	100.0	0.0	0.0	1.54	6.2	e

Complément C4

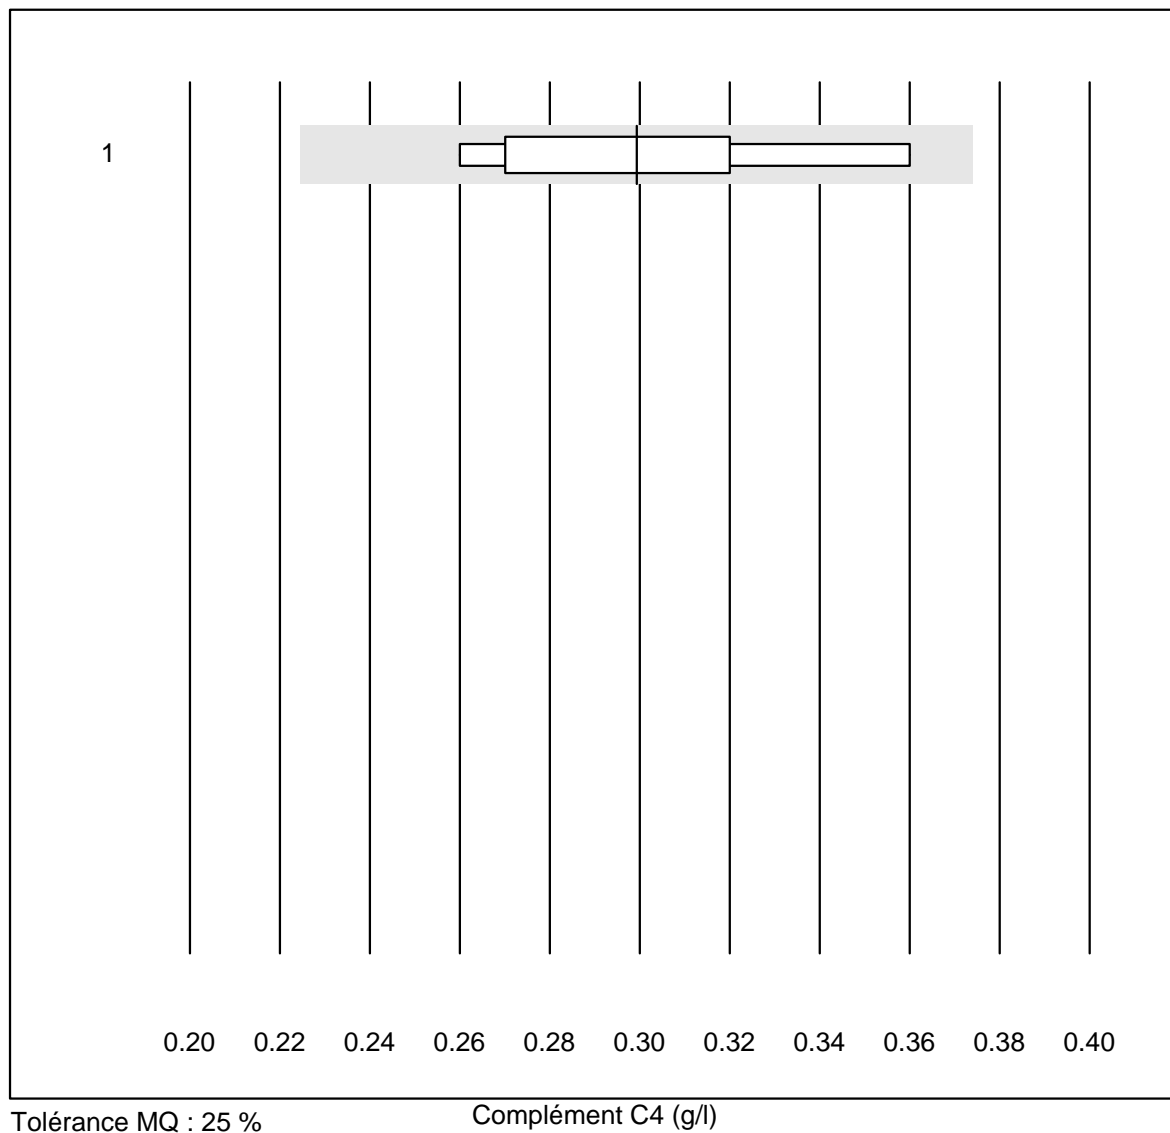


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	14	100.0	0.0	0.0	0.30	11.3	e*

Haptoglobine

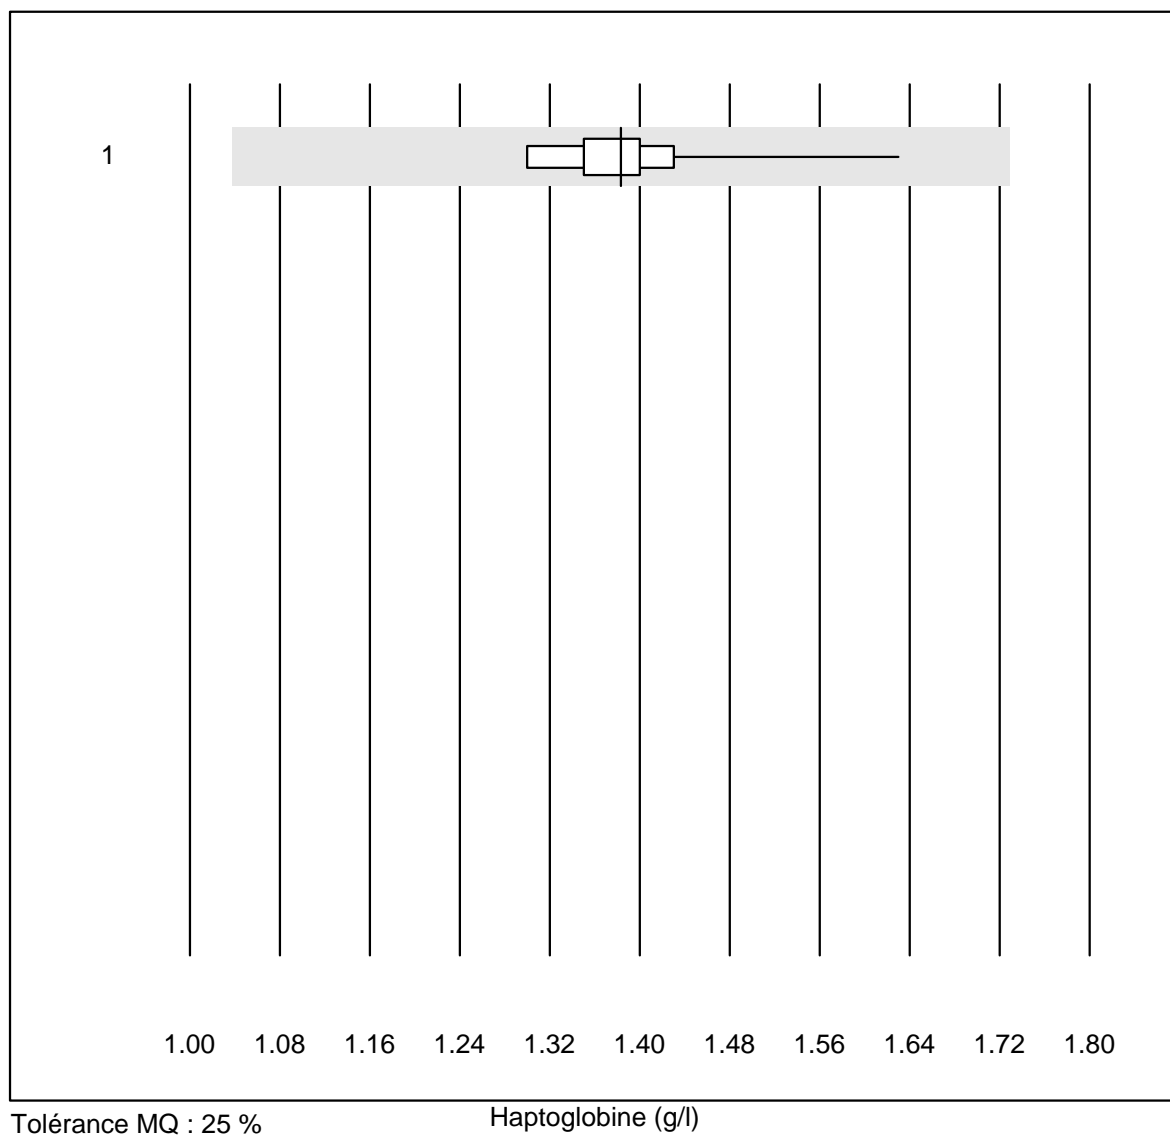


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	16	100.0	0.0	0.0	1.38	5.4	e

Transferrine

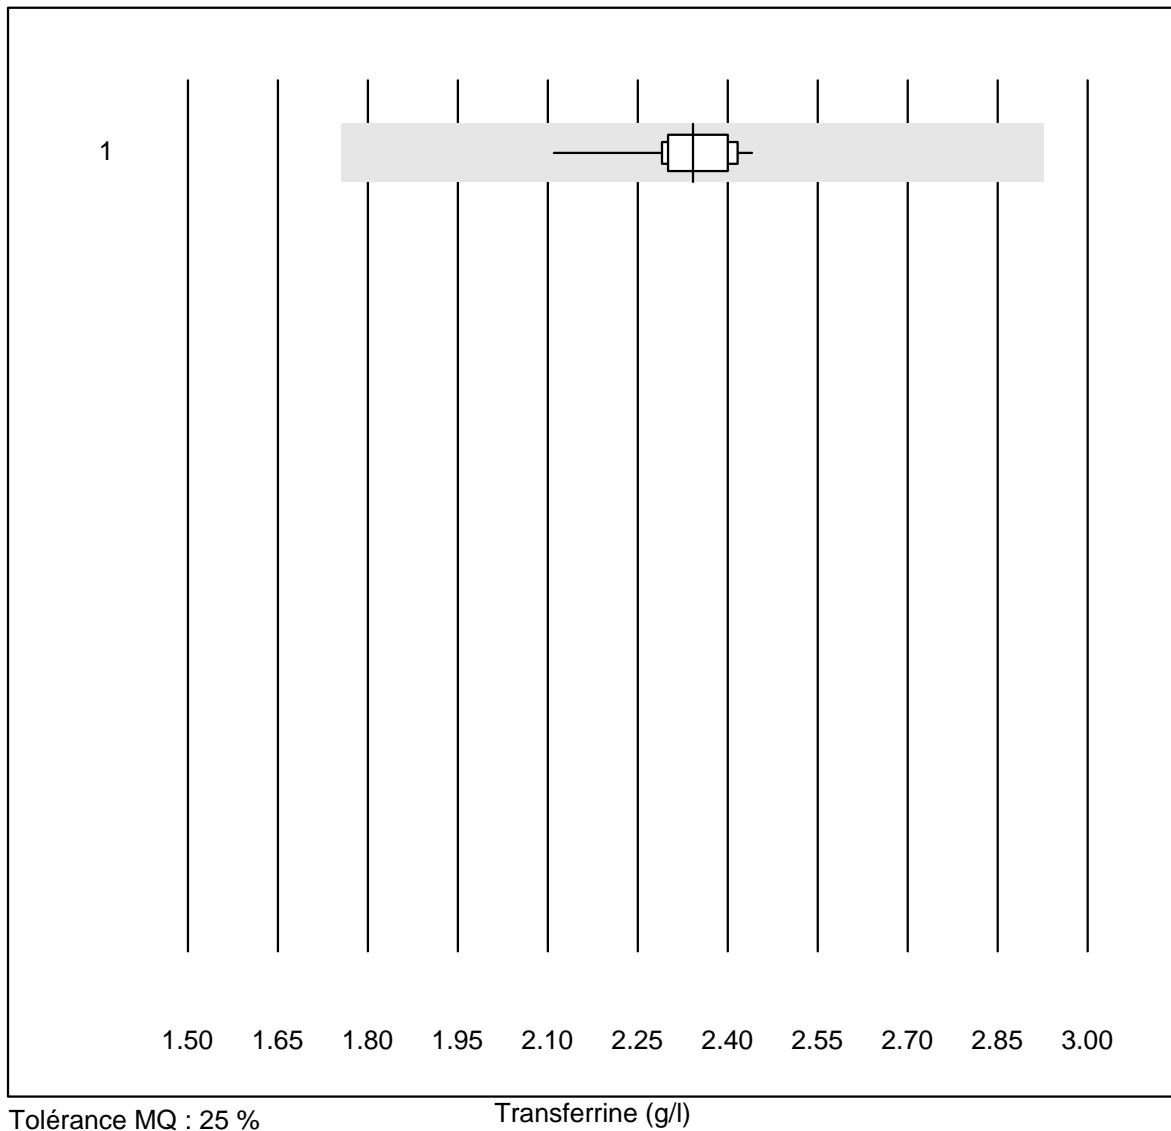


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	24	95.8	0.0	4.2	2.34	3.1	e

Beta-2-Mikroglobulin

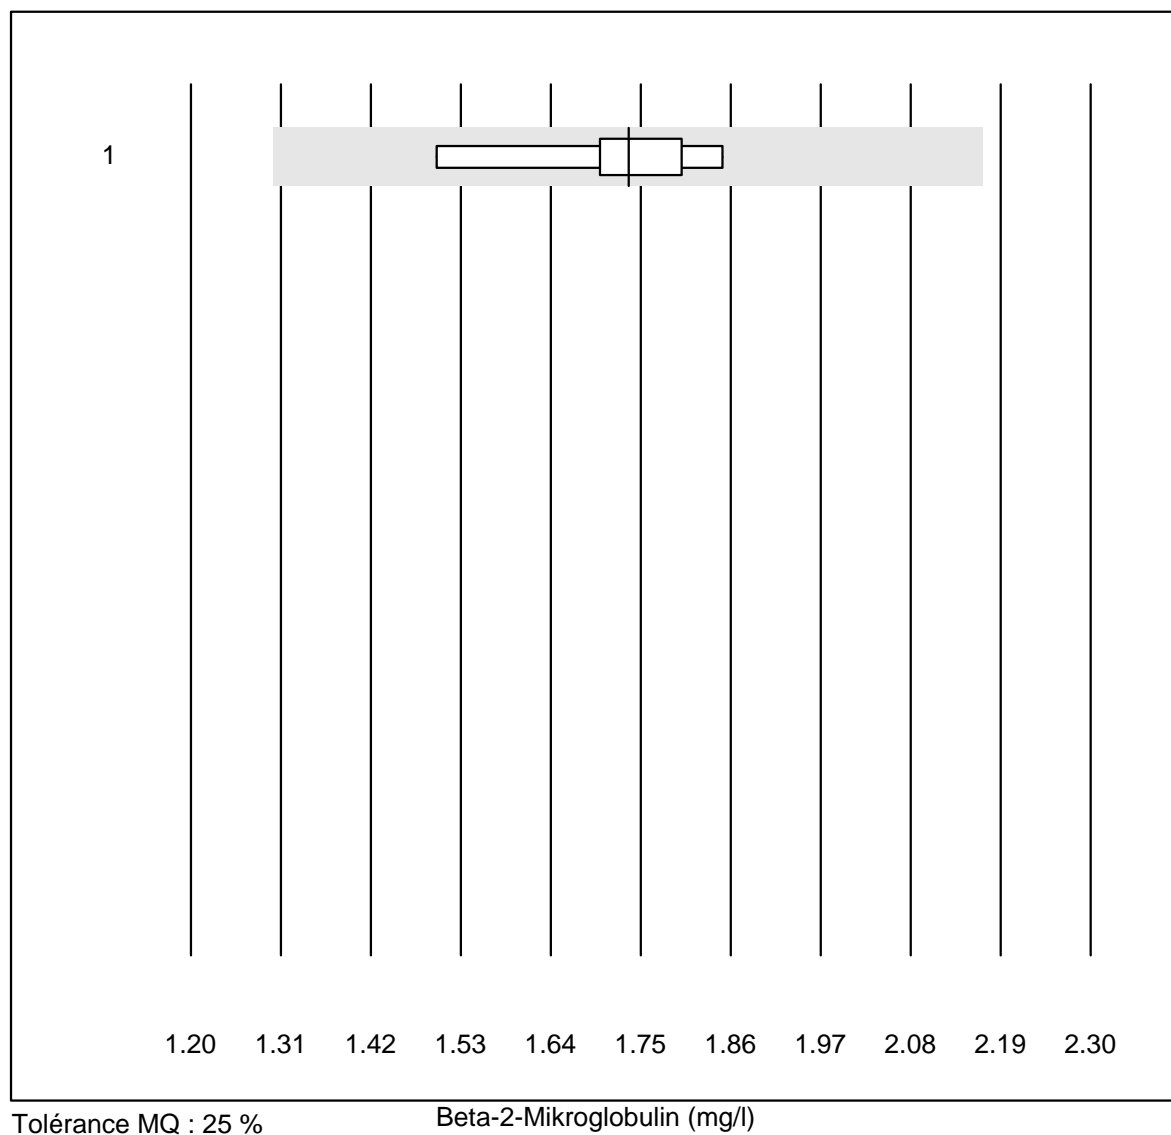


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	1.74	7.0	e

Facteur rhumatoïde

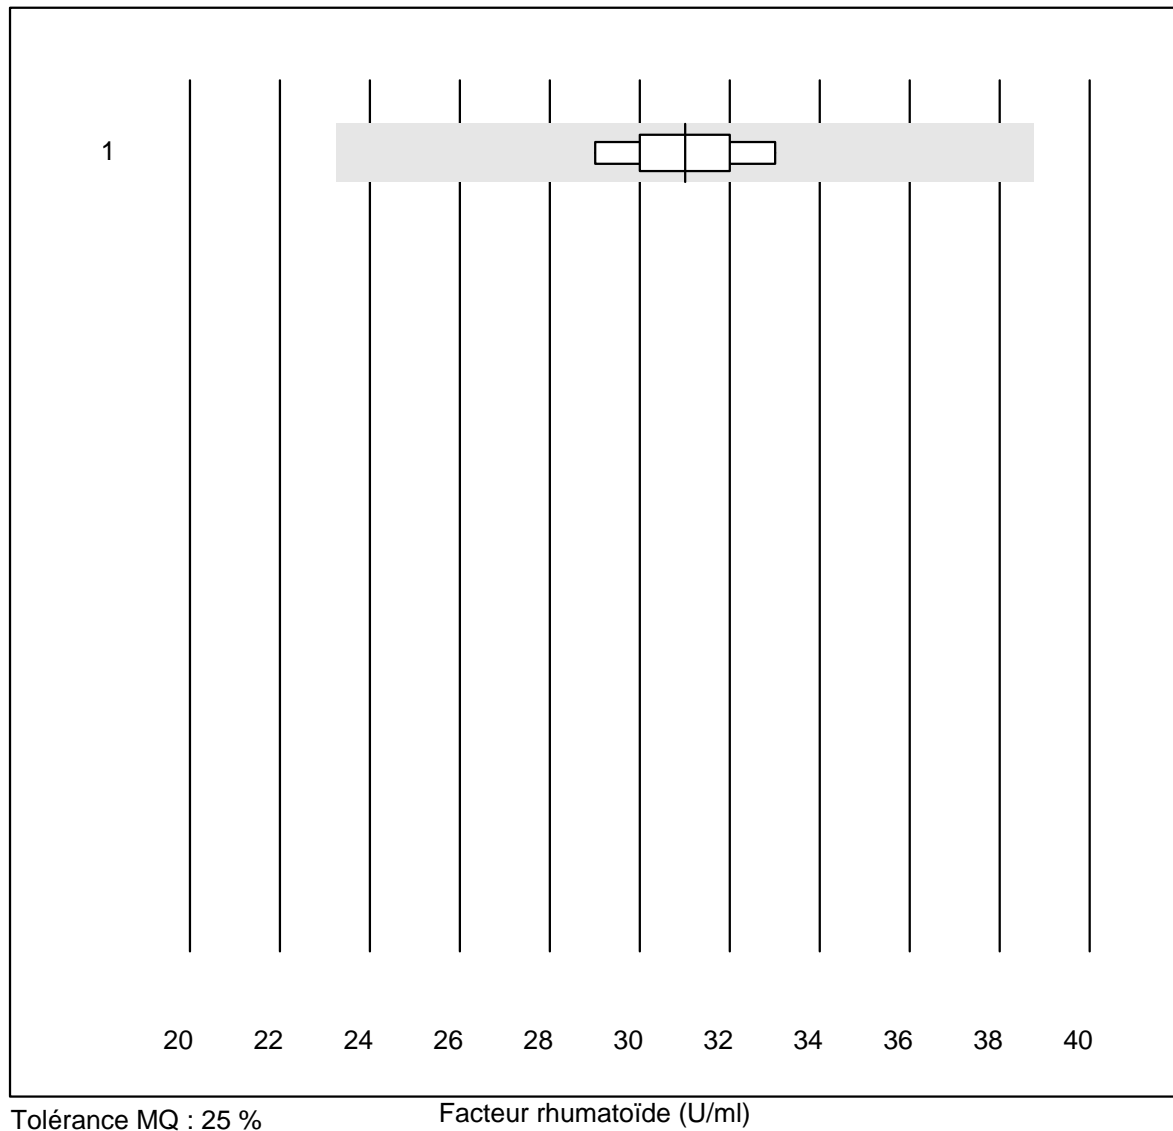


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	31.0	5.2	a

Ceruloplasmin

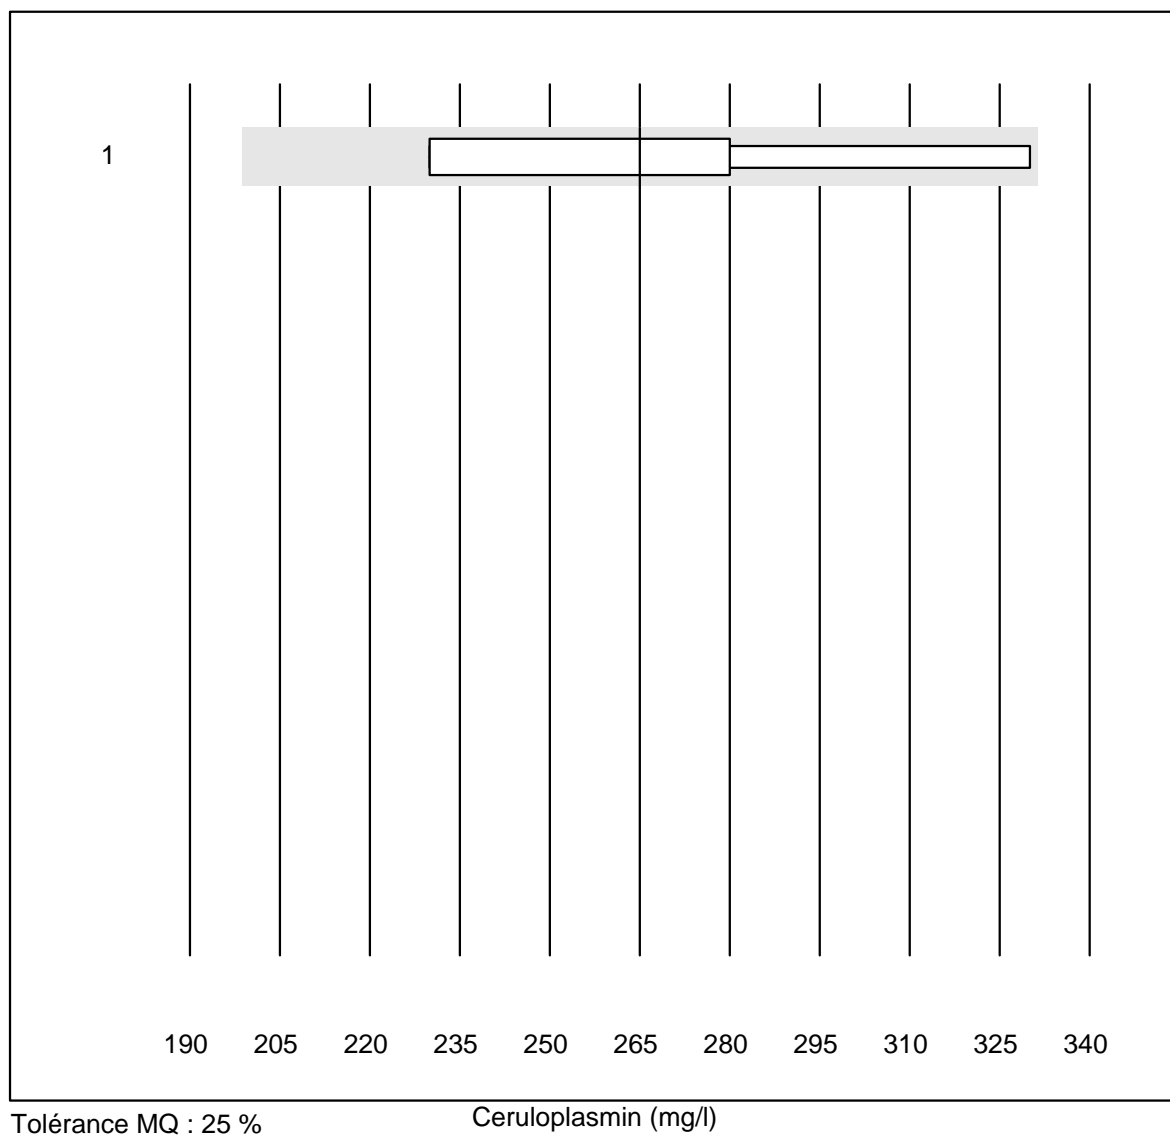


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	8	100.0	0.0	0.0	265.0	12.9	e*

Präalbumin

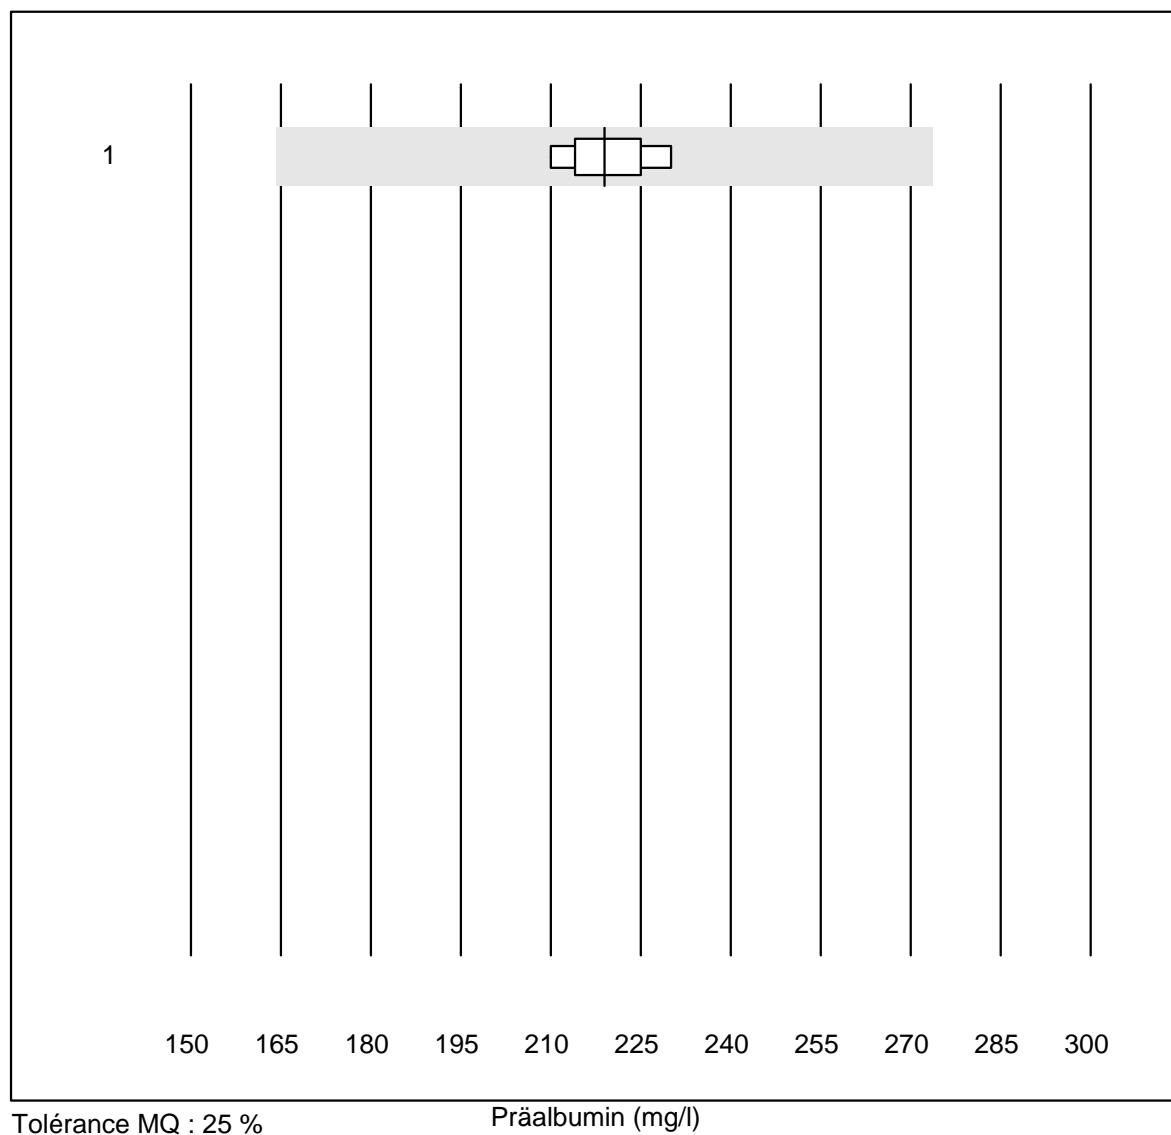

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	13	100.0	0.0	0.0	218.9	3.3	e

Récepteur soluble de la transferrine

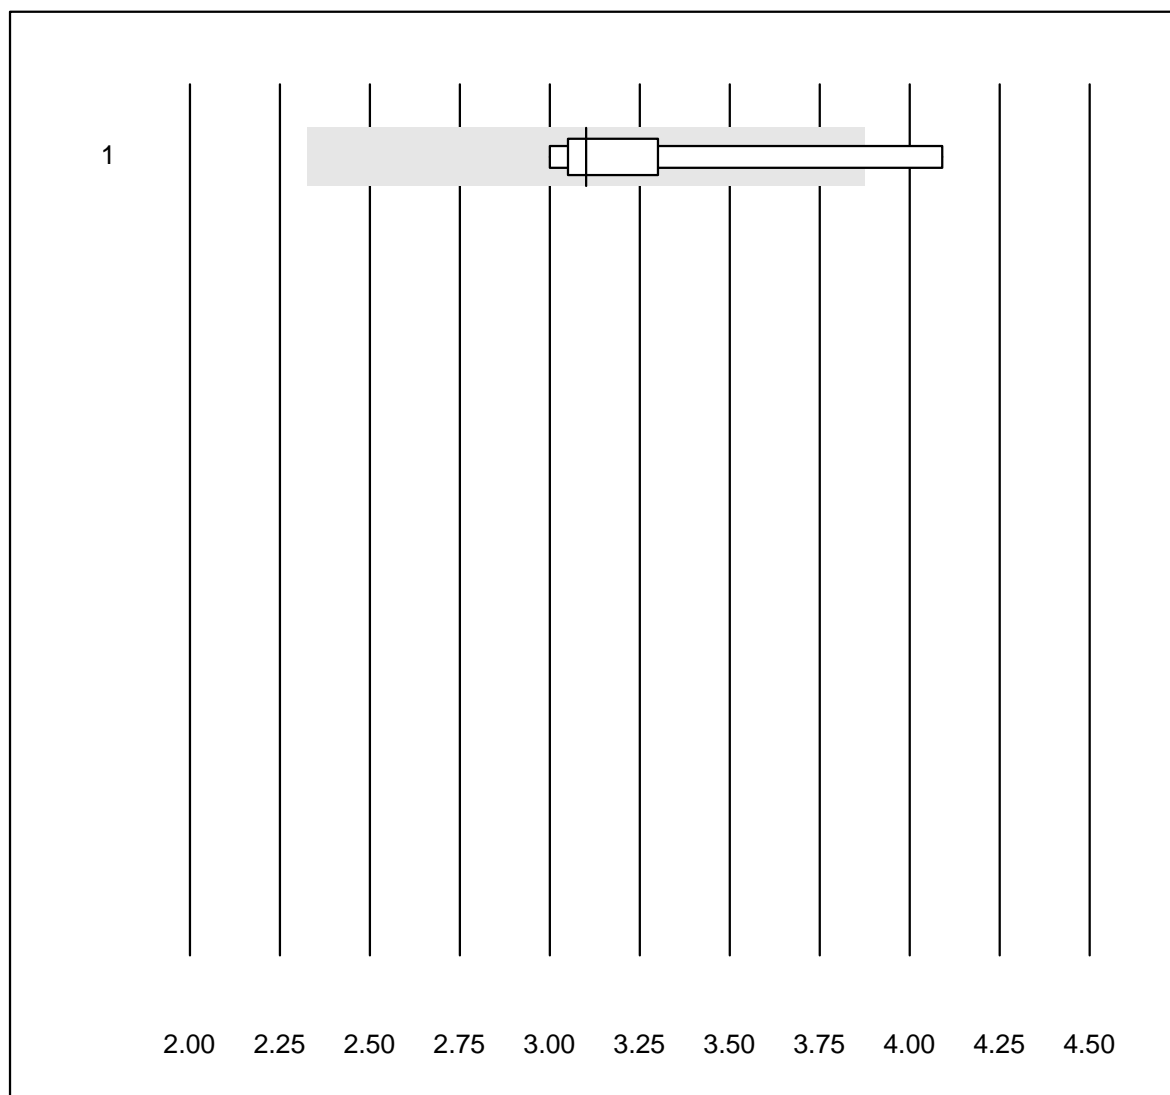


Tolérance MQ : 25 %

Récepteur soluble de la transferrine (mg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	5	80.0	20.0	0.0	3.1	13.7	e*

CRP HS

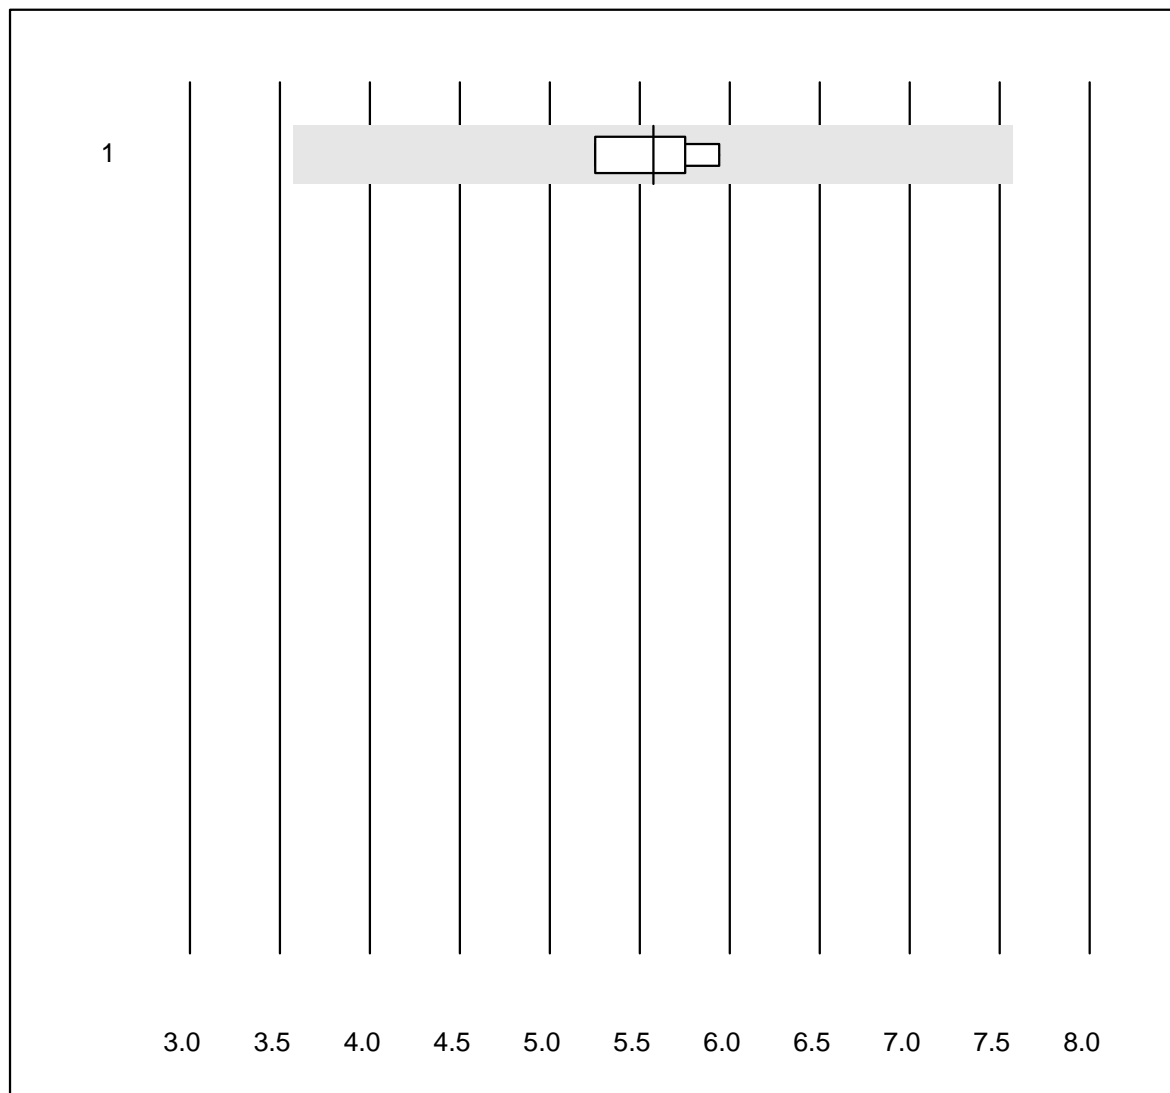


QUALAB Toleranz : 21 %
 (< 10.00: +/- 2.00 mg/l)

CRP HS (mg/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Turbidimetrie	4	100.0	0.0	0.0	5.58	5.7	e*


CRP

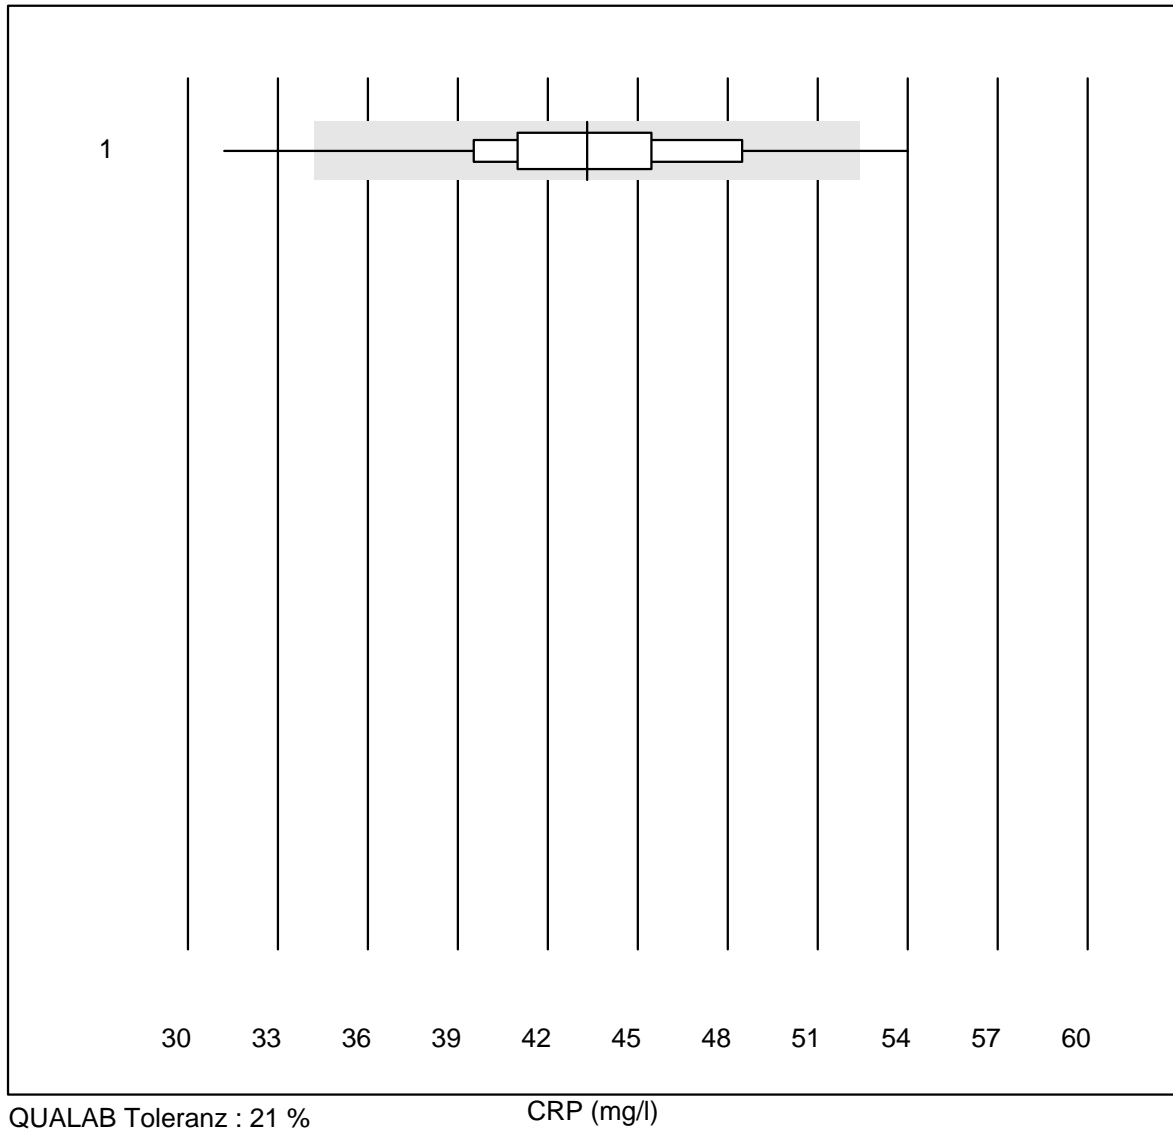

QUALAB Toleranz : 21 %


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 AFIAS	98	92.9	5.1	2.0	43.3	9.0	e

Albumine

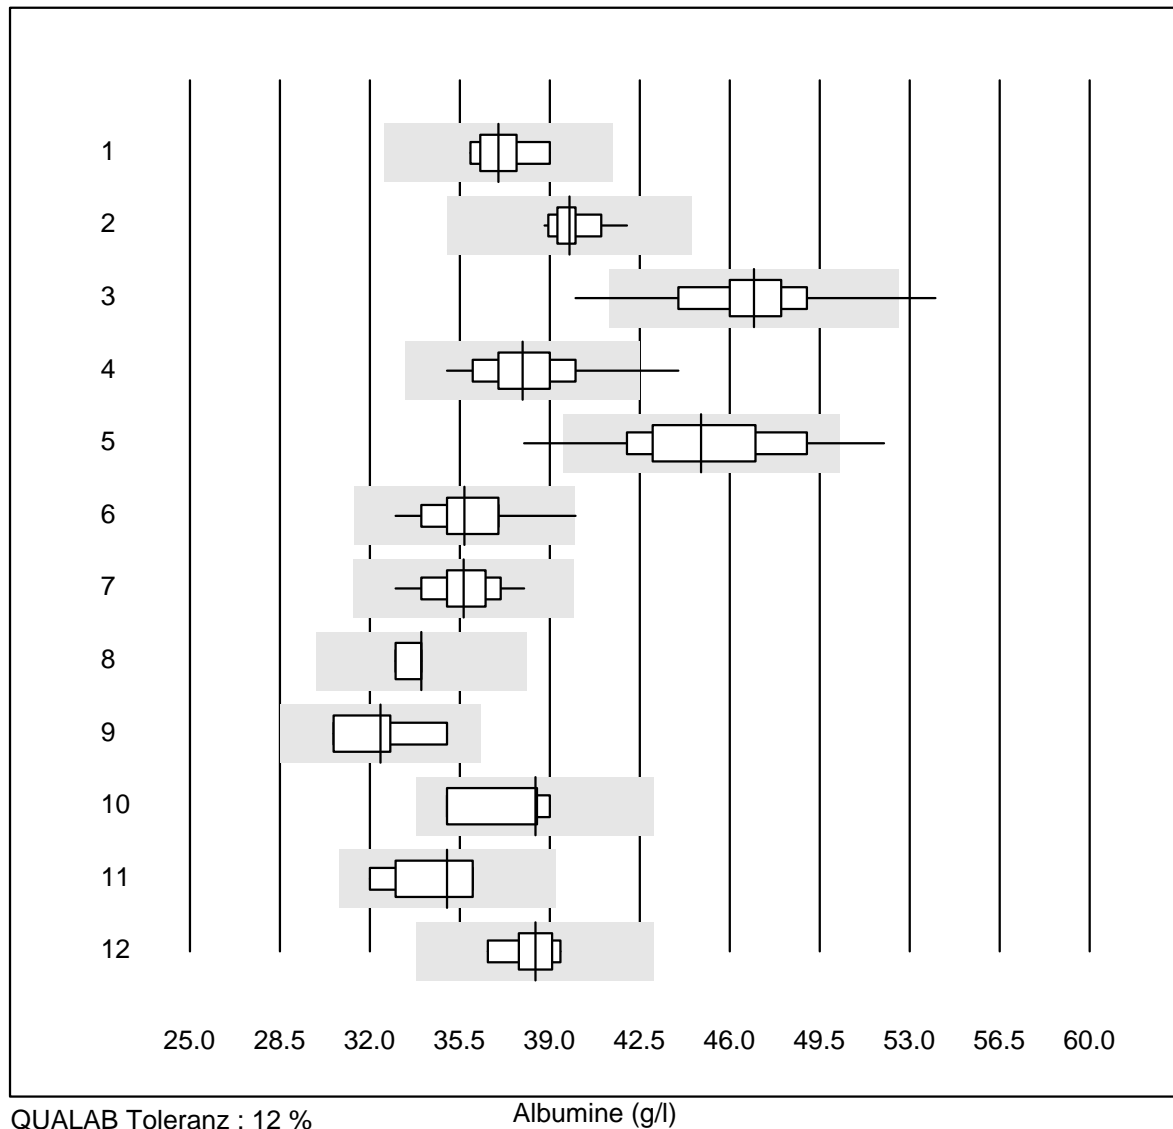


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	9	100.0	0.0	0.0	37	2.7	e
2	Cobas	17	88.2	0.0	11.8	40	2.1	e
3	Fuji Dri-Chem	229	97.0	1.3	1.7	47	4.6	e
4	Spotchem/Ready	32	90.6	6.3	3.1	38	5.6	e
5	Spotchem D-Concept	134	95.6	3.7	0.7	45	6.2	e
6	Piccolo	53	96.2	1.9	1.9	36	3.9	e
7	Beckmann	15	100.0	0.0	0.0	36	3.6	e
8	Skyla	5	100.0	0.0	0.0	34	1.6	e
9	Dimension	4	100.0	0.0	0.0	32	5.6	e*
10	Abx Mira	4	100.0	0.0	0.0	38	4.9	e*
11	Hitachi S40/M40	9	100.0	0.0	0.0	35	4.4	e*
12	Autolyser/DiaSys	6	100.0	0.0	0.0	38	2.7	e

Phosphatase alcaline

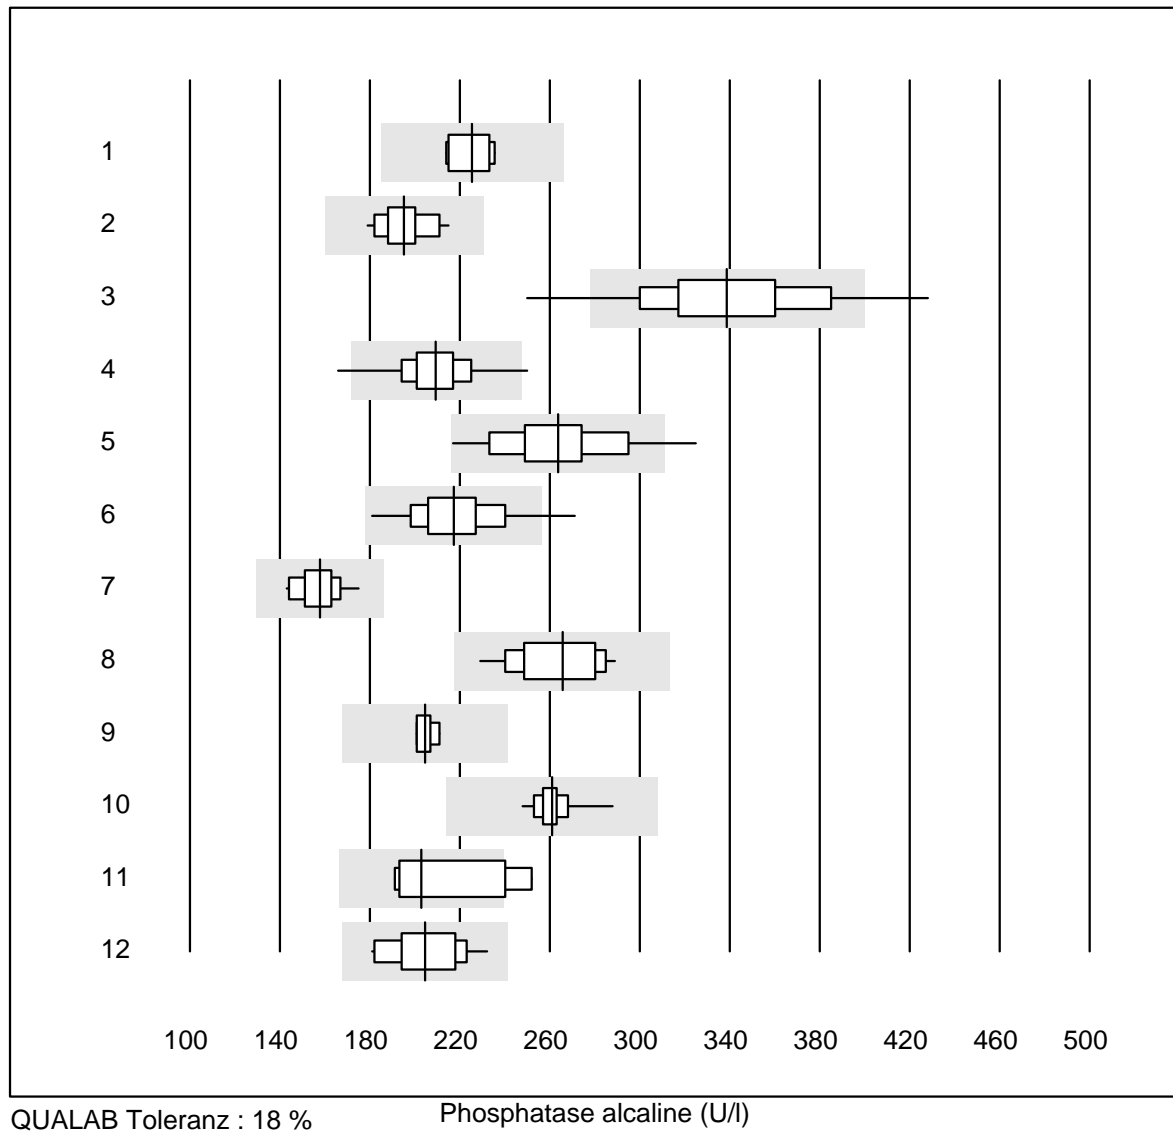


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	7	100.0	0.0	0.0	226	3.8	e
2 Cobas	20	100.0	0.0	0.0	195	5.1	e
3 Reflotron	531	90.8	6.4	2.8	339	9.8	e
4 Fuji Dri-Chem	781	98.9	0.3	0.8	209	5.7	e
5 Spotchem/Ready	62	93.6	3.2	3.2	264	8.7	e
6 Spotchem D-Concept	251	98.0	2.0	0.0	217	7.7	e
7 Hitachi S40/M40	15	100.0	0.0	0.0	158	5.5	e
8 Beckman	18	100.0	0.0	0.0	266	6.7	e
9 Dimension	4	100.0	0.0	0.0	205	2.3	e
10 Piccolo	46	100.0	0.0	0.0	261	2.8	e
11 Abx Mira	7	71.4	28.6	0.0	203	11.3	e*
12 Autolyser/DiaSys	17	100.0	0.0	0.0	204	7.4	e

Amylase

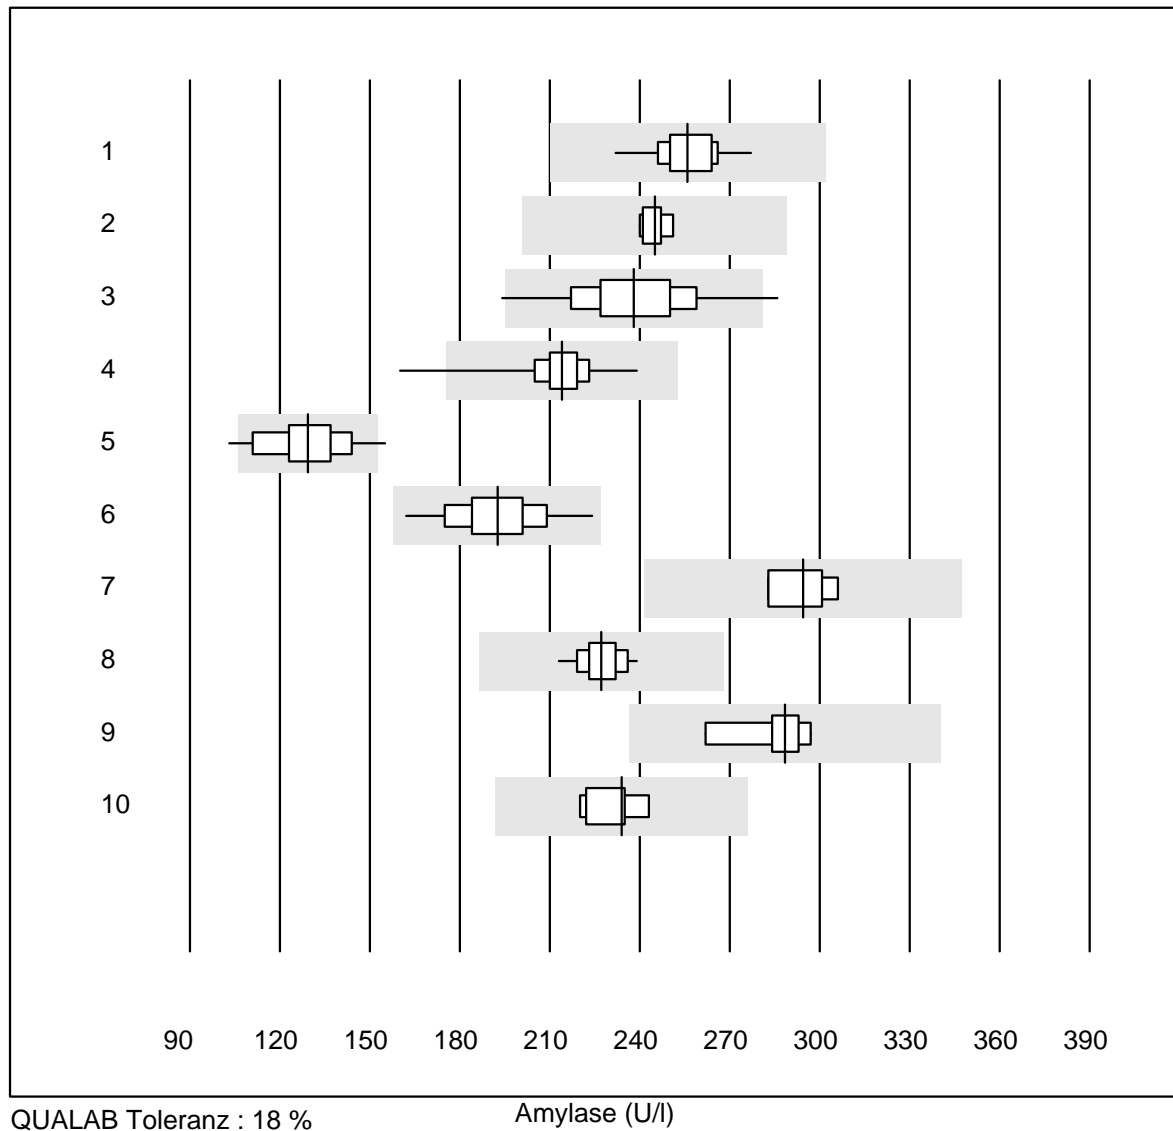


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	14	100.0	0.0	0.0	256	4.3	e
2 Cobas	6	100.0	0.0	0.0	245	1.6	e
3 Reflotron	138	94.2	2.9	2.9	238	7.1	e
4 Fuji Dri-Chem	572	99.3	0.2	0.5	214	3.7	e
5 Spotchem/Ready	42	90.4	4.8	4.8	129	9.2	e
6 Spotchem D-Concept	196	99.0	0.0	1.0	193	6.7	e
7 Architect	4	100.0	0.0	0.0	294	3.7	e
8 Piccolo	43	100.0	0.0	0.0	227	2.9	e
9 Hitachi S40/M40	8	87.5	0.0	12.5	289	4.0	e
10 Autolyser/DiaSys	6	100.0	0.0	0.0	234	3.8	e

Amylase pancréatique

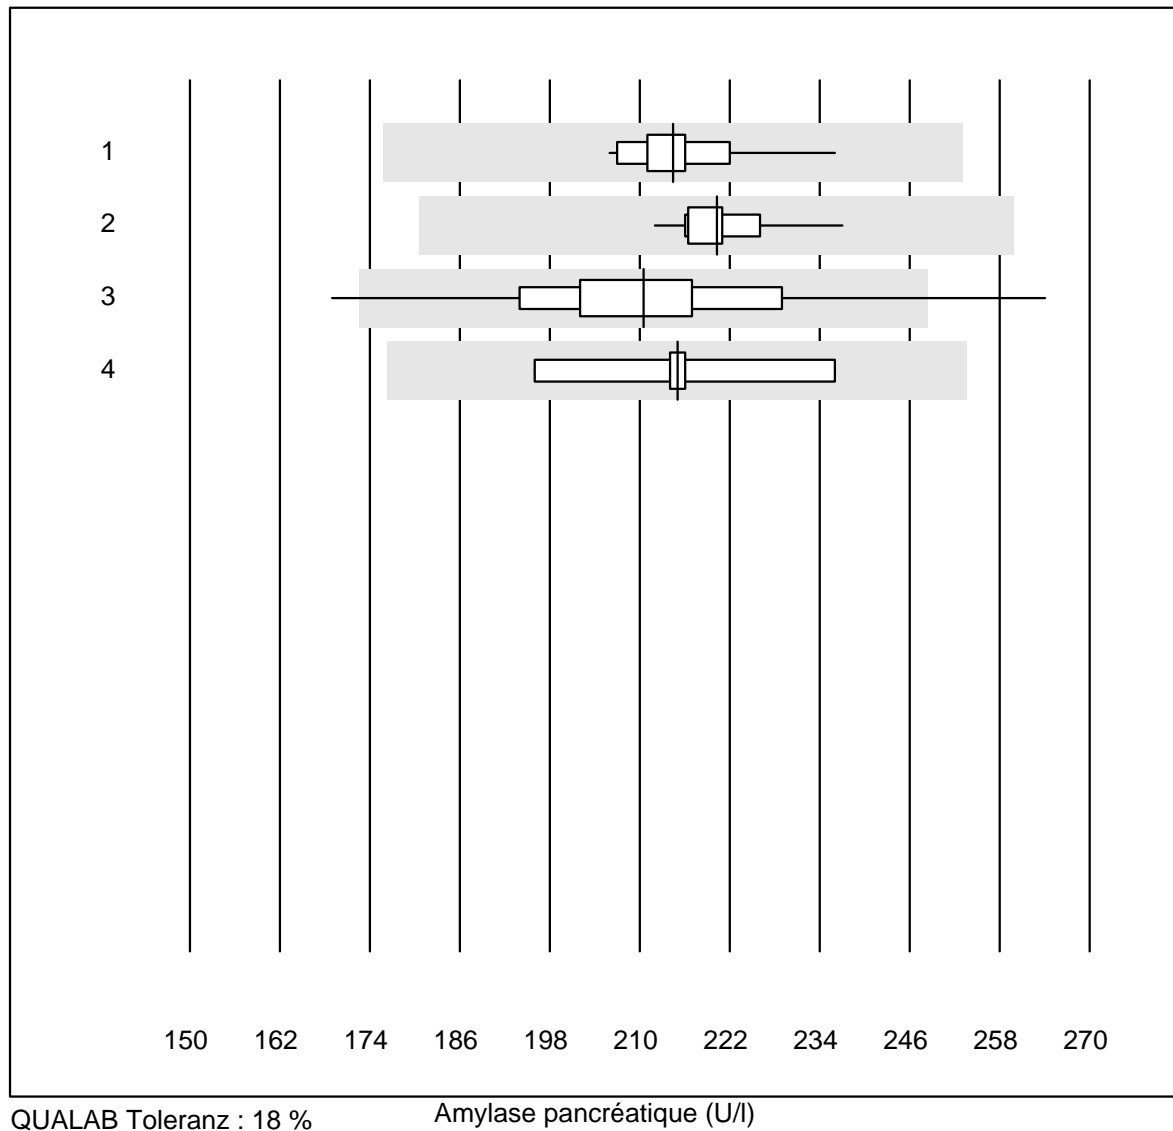

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	23	100.0	0.0	0.0	214	3.5	e
2 Cobas	12	100.0	0.0	0.0	220	2.9	e
3 Reflotron	363	96.9	2.5	0.6	210	6.8	e
4 Autolyser/DiaSys	9	100.0	0.0	0.0	215	5.1	e

Bilirubine totale

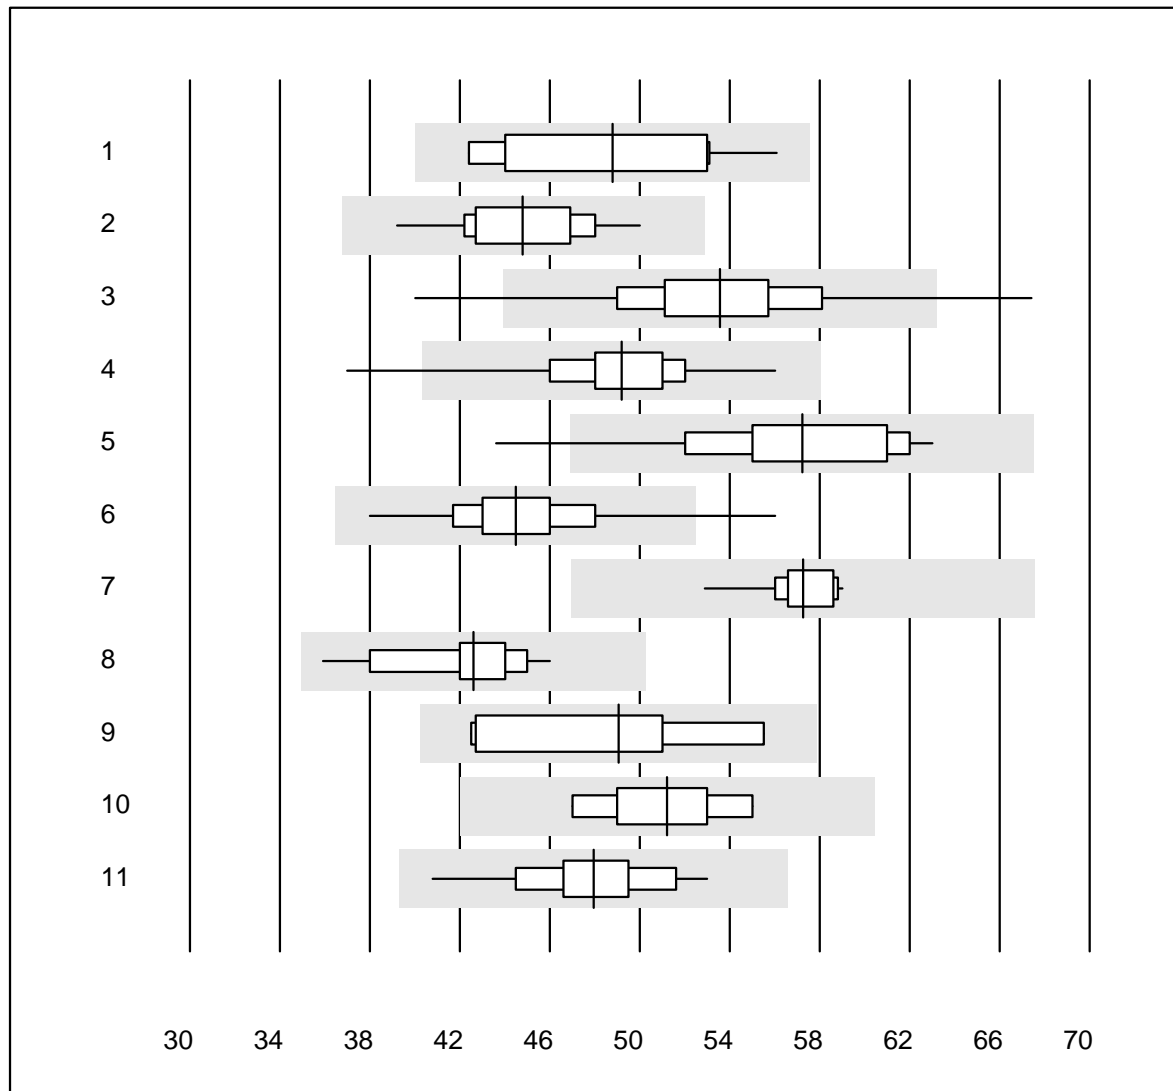


QUALAB Toleranz : 18 %

Bilirubine totale (µmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	11	90.9	0.0	9.1	48.8	10.0	e*
2	Cobas	19	100.0	0.0	0.0	44.8	5.9	e
3	Reflotron	393	95.7	2.5	1.8	53.6	7.2	e
4	Fuji Dri-Chem	622	96.7	1.0	2.3	49.2	5.4	e
5	Spotchem/Ready	57	91.2	3.5	5.3	57.2	7.4	e
6	Spotchem D-Concept	203	97.5	0.5	2.0	44.5	5.8	e
7	Beckman	15	100.0	0.0	0.0	57.2	2.7	e
8	Piccolo	49	98.0	0.0	2.0	42.6	5.8	e
9	Abx Mira	8	100.0	0.0	0.0	49.1	9.3	e*
10	Hitachi S40/M40	11	90.9	0.0	9.1	51.2	5.4	e
11	Autolyser/DiaSys	15	100.0	0.0	0.0	48.0	6.0	e

Bilirubine directe

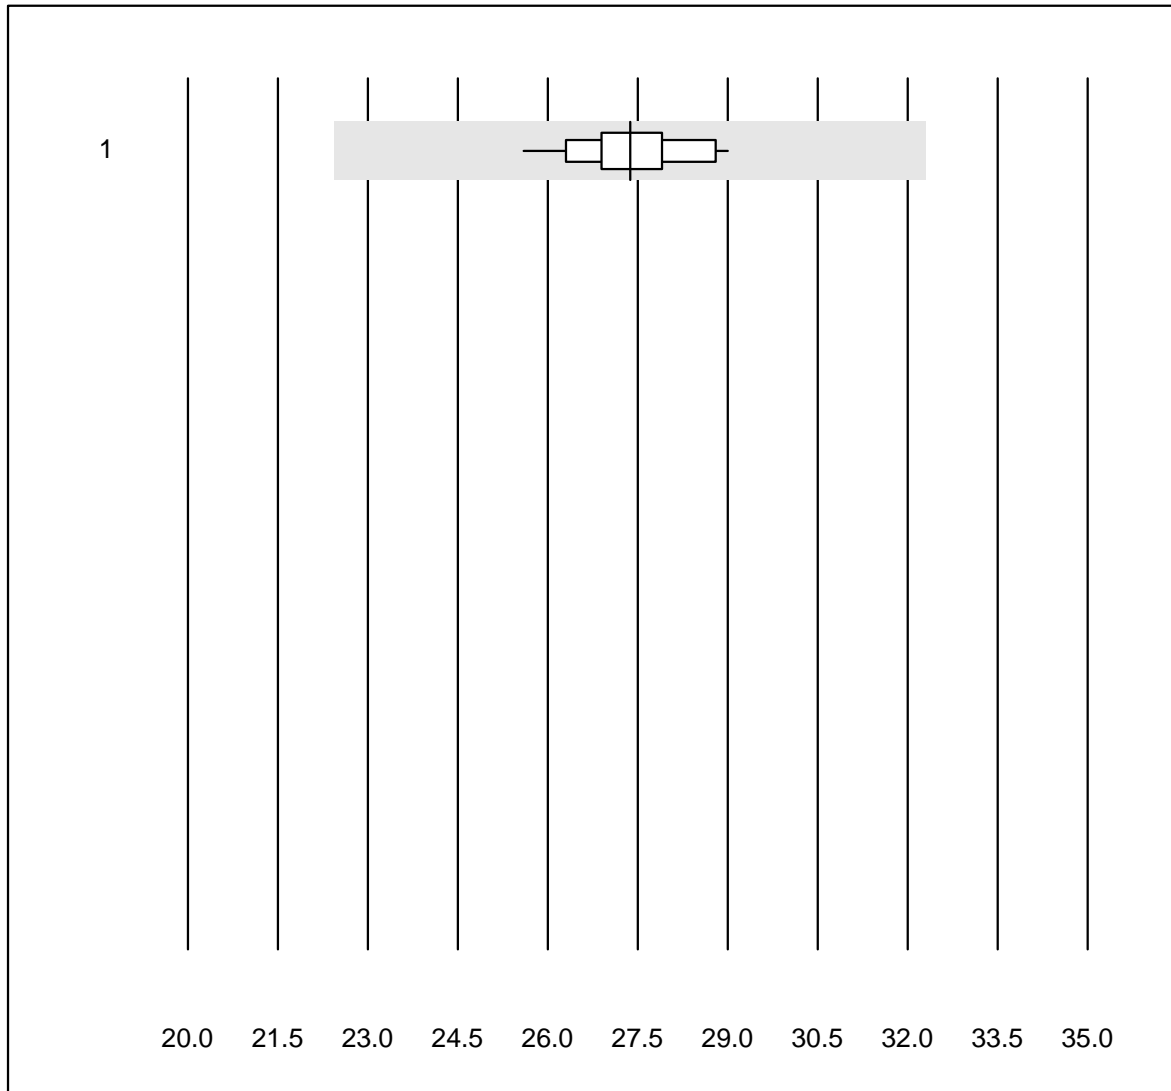


Tolérance MQ : 18 %

Bilirubine directe (µmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Fuji Dri-Chem	26	96.2	0.0	3.8	27.4	3.4	e

Calcium

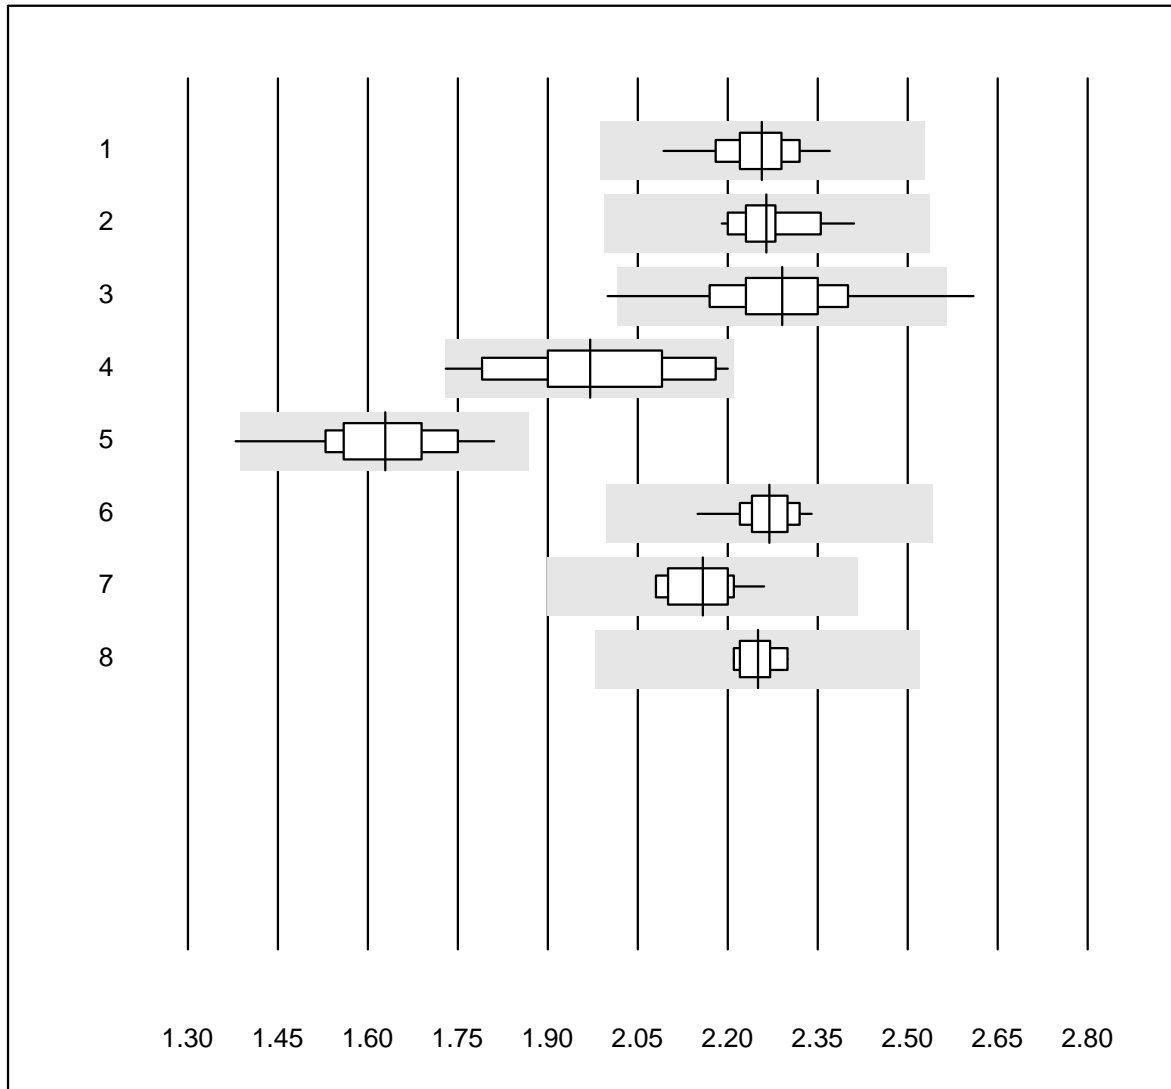


QUALAB Toleranz : 12 %
(< 2.00: +/- 0.24 mmol/l)

Calcium (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	34	100.0	0.0	0.0	2.26	2.7	e
2	Cobas	19	100.0	0.0	0.0	2.26	2.4	e
3	Fuji Dri-Chem	378	98.1	0.8	1.1	2.29	4.1	e
4	Spotchem/Ready	19	94.7	5.3	0.0	1.97	6.7	e*
5	Spotchem D-Concept	94	97.8	1.1	1.1	1.63	5.5	e
6	Piccolo	49	100.0	0.0	0.0	2.27	1.8	e
7	Hitachi S40/M40	10	100.0	0.0	0.0	2.16	2.8	e
8	Autolyser/DiaSys	9	100.0	0.0	0.0	2.25	1.4	e

Calcium ISE

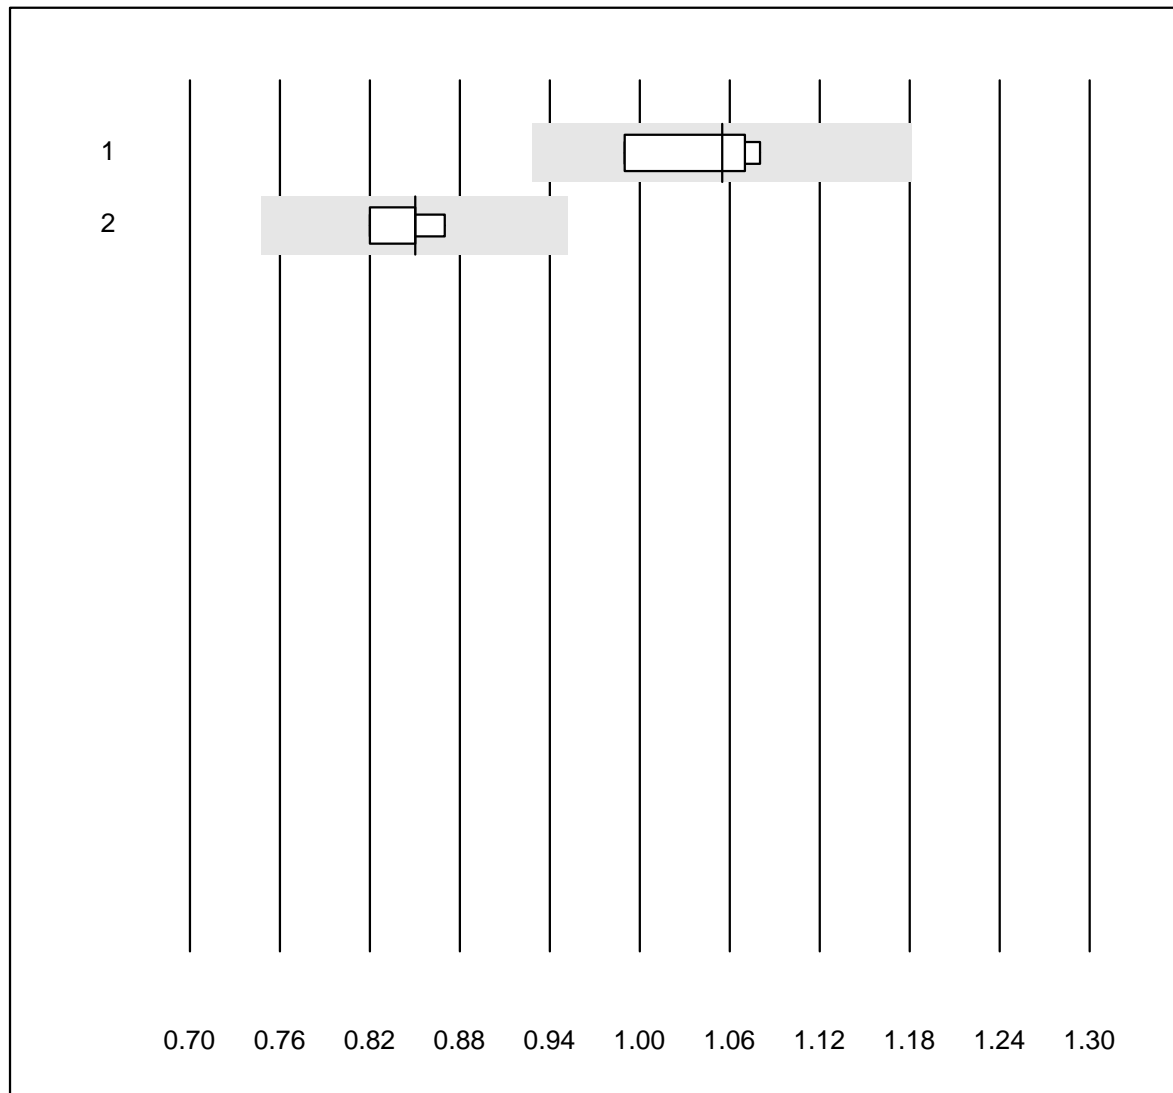


Tolérance MQ : 12 %

Calcium ISE (mmol/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 ISE direct	4	100.0	0.0	0.0	1.06	3.9	e*
2 iStat Chem8	4	100.0	0.0	0.0	0.85	2.4	e

Chlorures

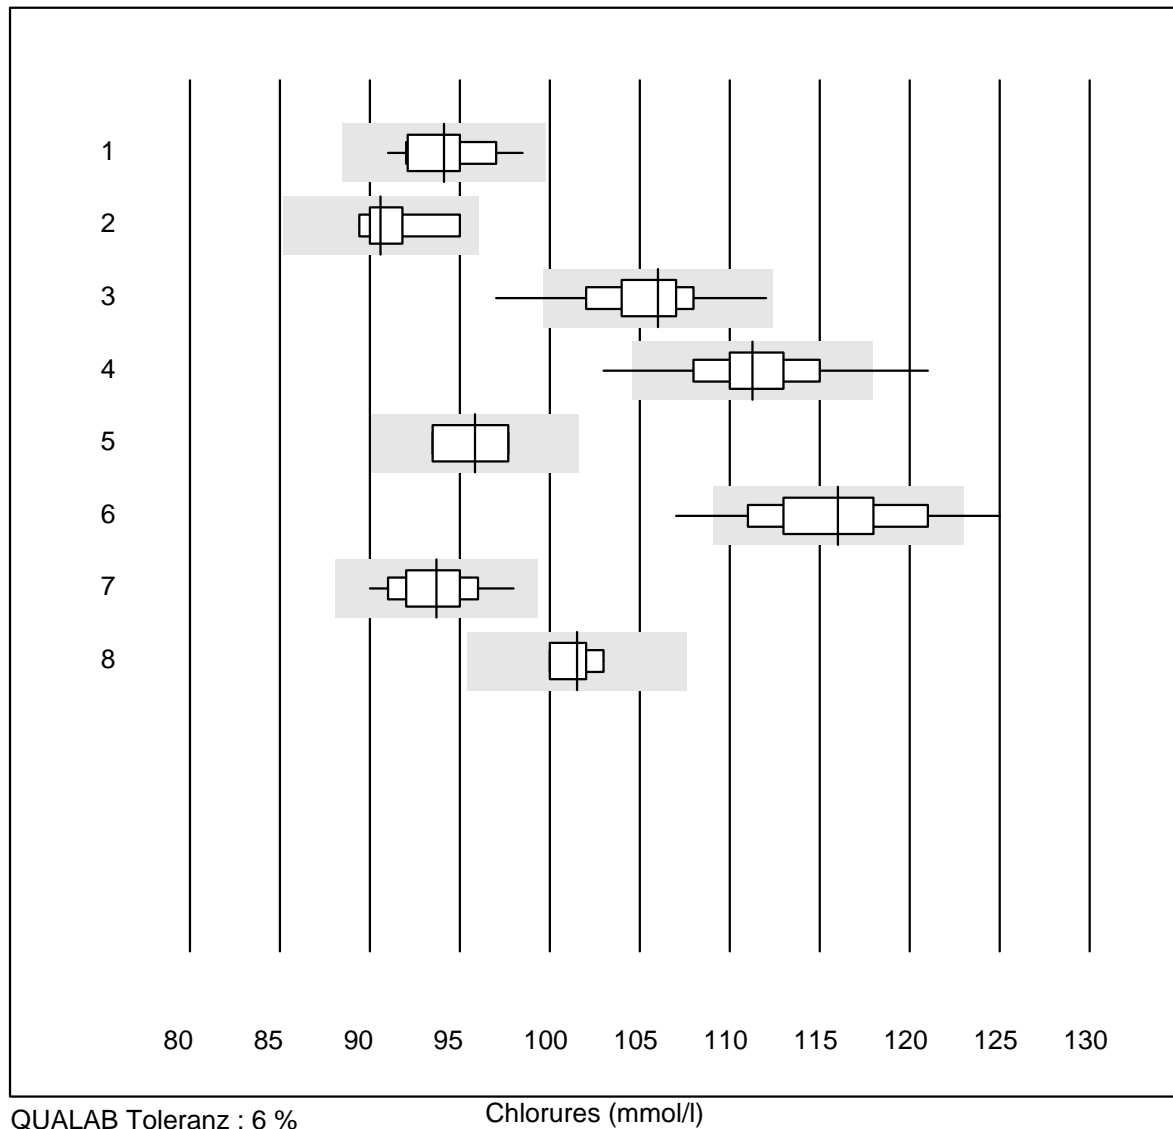


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 ISE	32	96.9	0.0	3.1	94	2.3	e
2 Cobas	9	100.0	0.0	0.0	91	2.4	e*
3 Fuji Dri-Chem	725	96.4	2.5	1.1	106	2.2	e
4 Spotchem D-Concept	233	94.8	4.3	0.9	111	2.6	e
5 Chimie humide	4	75.0	0.0	25.0	96	2.4	e*
6 Spotchem EL-SE 1520	77	87.0	10.4	2.6	116	3.4	e
7 Piccolo	26	100.0	0.0	0.0	94	2.1	e
8 iStat Chem8	4	100.0	0.0	0.0	102	1.3	e

Cholestérol

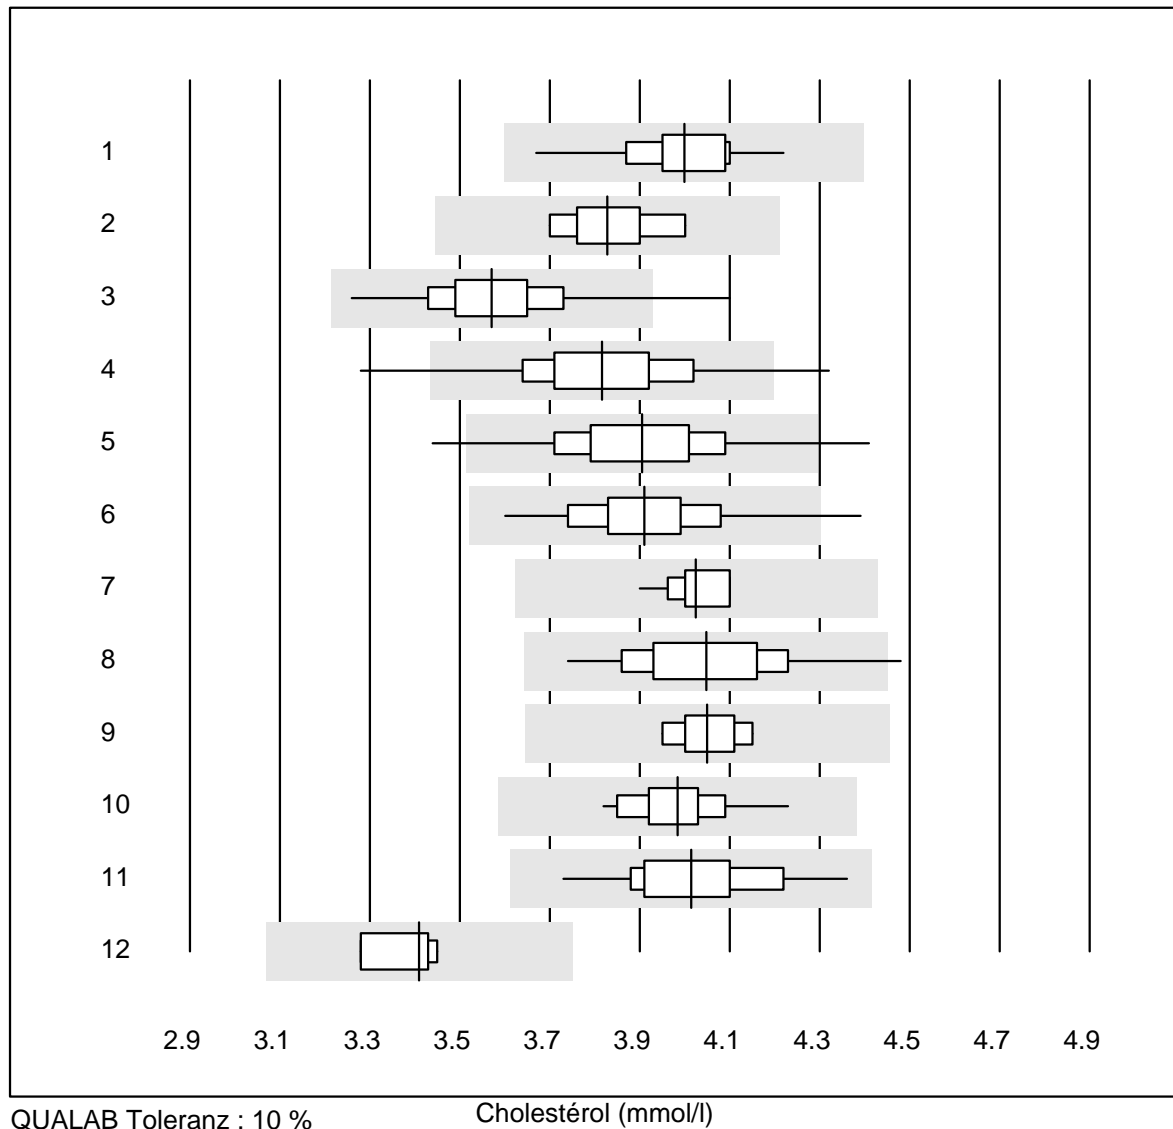


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	31	100.0	0.0	0.0	4.00	2.8	e
2	Cobas	19	100.0	0.0	0.0	3.83	2.5	e
3	Reflotron	502	98.4	1.0	0.6	3.57	3.5	e
4	Fuji Dri-Chem	781	96.4	1.9	1.7	3.82	4.1	e
5	Spotchem/Ready	85	92.9	5.9	1.2	3.91	4.5	e
6	Spotchem D-Concept	260	98.0	0.8	1.2	3.91	3.5	e
7	Piccolo	23	100.0	0.0	0.0	4.02	1.6	e
8	Cholestech LDX	126	96.8	0.8	2.4	4.05	3.6	e
9	Abx Mira	7	100.0	0.0	0.0	4.05	1.7	e
10	Hitachi S40/M40	13	100.0	0.0	0.0	3.98	2.8	e
11	Autolyser/DiaSys	17	100.0	0.0	0.0	4.01	3.8	e
12	Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	3.41	2.2	e

Cholestérol HDL

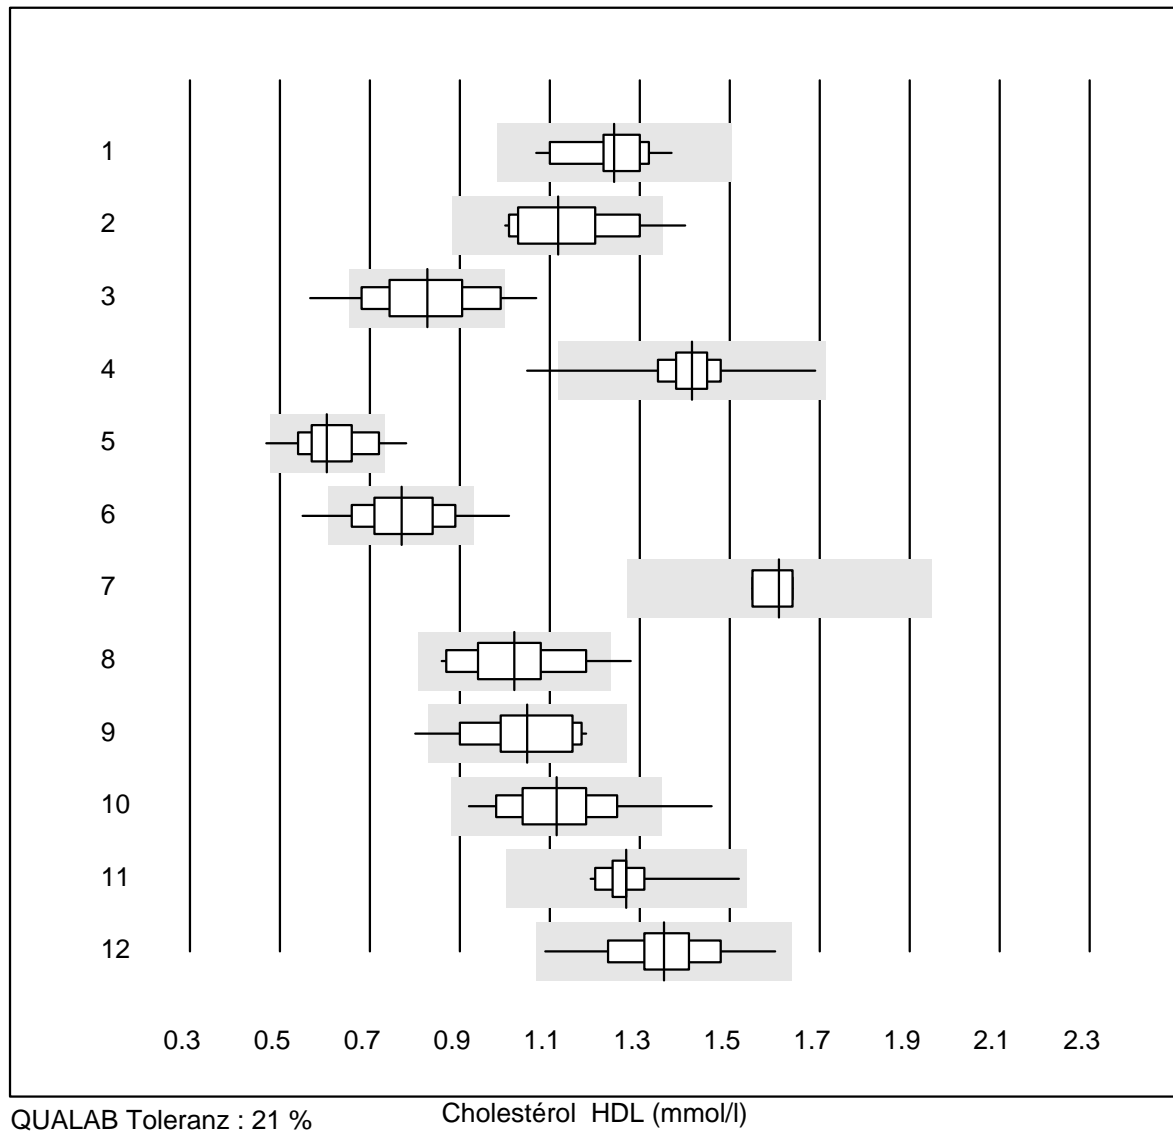

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	humide, direct	20	95.0	0.0	5.0	1.24	6.7	e
2	Cobas	18	94.4	5.6	0.0	1.12	10.5	e
3	Reflotron	367	72.5	12.8	14.7	0.83	14.3	e
4	Fuji Dri-Chem	752	99.4	0.1	0.5	1.42	4.1	e
5	Spotchem/Ready	74	85.1	8.1	6.8	0.61	11.6	e
6	Spotchem D-Concept	254	87.0	8.3	4.7	0.77	12.0	e
7	Dimension	4	100.0	0.0	0.0	1.61	2.8	e
8	Piccolo	21	90.5	9.5	0.0	1.02	11.8	e*
9	Pentra/Selectra	12	91.7	8.3	0.0	1.05	11.1	e*
10	Cholestech LDX	125	91.2	3.2	5.6	1.11	9.7	e
11	Hitachi S40/M40	13	100.0	0.0	0.0	1.27	6.5	e
12	Autolyser/DiaSys	17	100.0	0.0	0.0	1.35	8.4	e

Créatine-kinase

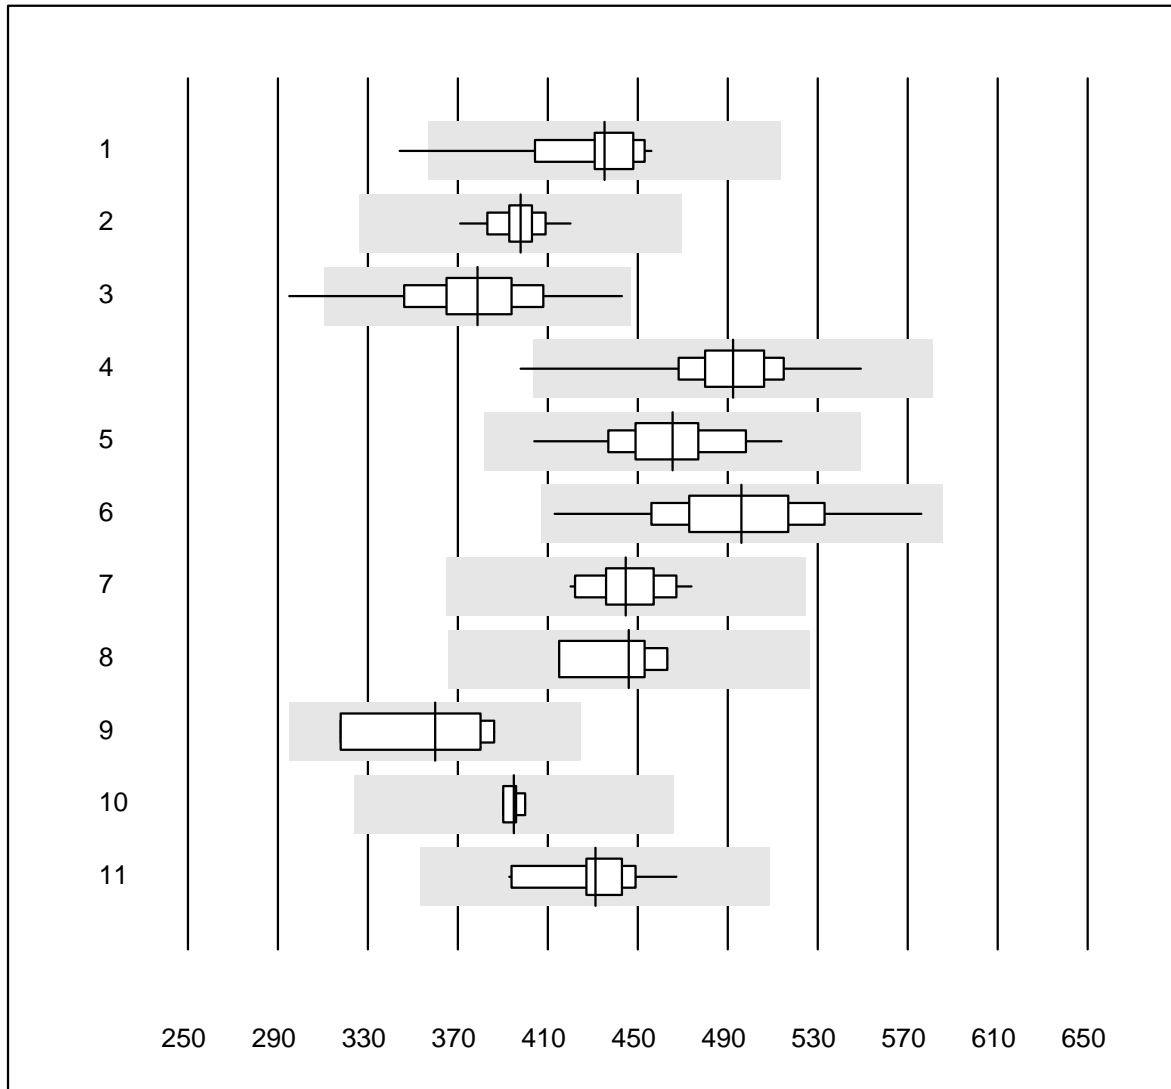


QUALAB Toleranz : 18 %

Créatine-kinase (U/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	28	96.4	3.6	0.0	435	5.1	e
2 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	398	2.8	e
3 Reflotron	349	96.0	1.4	2.6	379	6.7	e
4 Fuji Dri-Chem	509	97.8	0.2	2.0	492	4.1	e
5 Spotchem/Ready	37	97.3	0.0	2.7	465	5.3	e
6 Spotchem D-Concept	157	100.0	0.0	0.0	496	6.5	e
7 Piccolo	18	100.0	0.0	0.0	445	3.4	e
8 Abx Mira	4	100.0	0.0	0.0	446	4.7	e*
9 Hitachi S40/M40	5	80.0	0.0	20.0	360	8.5	e*
10 Dimension	4	100.0	0.0	0.0	395	1.1	e
11 Autolyser/DiaSys	14	100.0	0.0	0.0	431	4.6	e

LDL Cholesterin

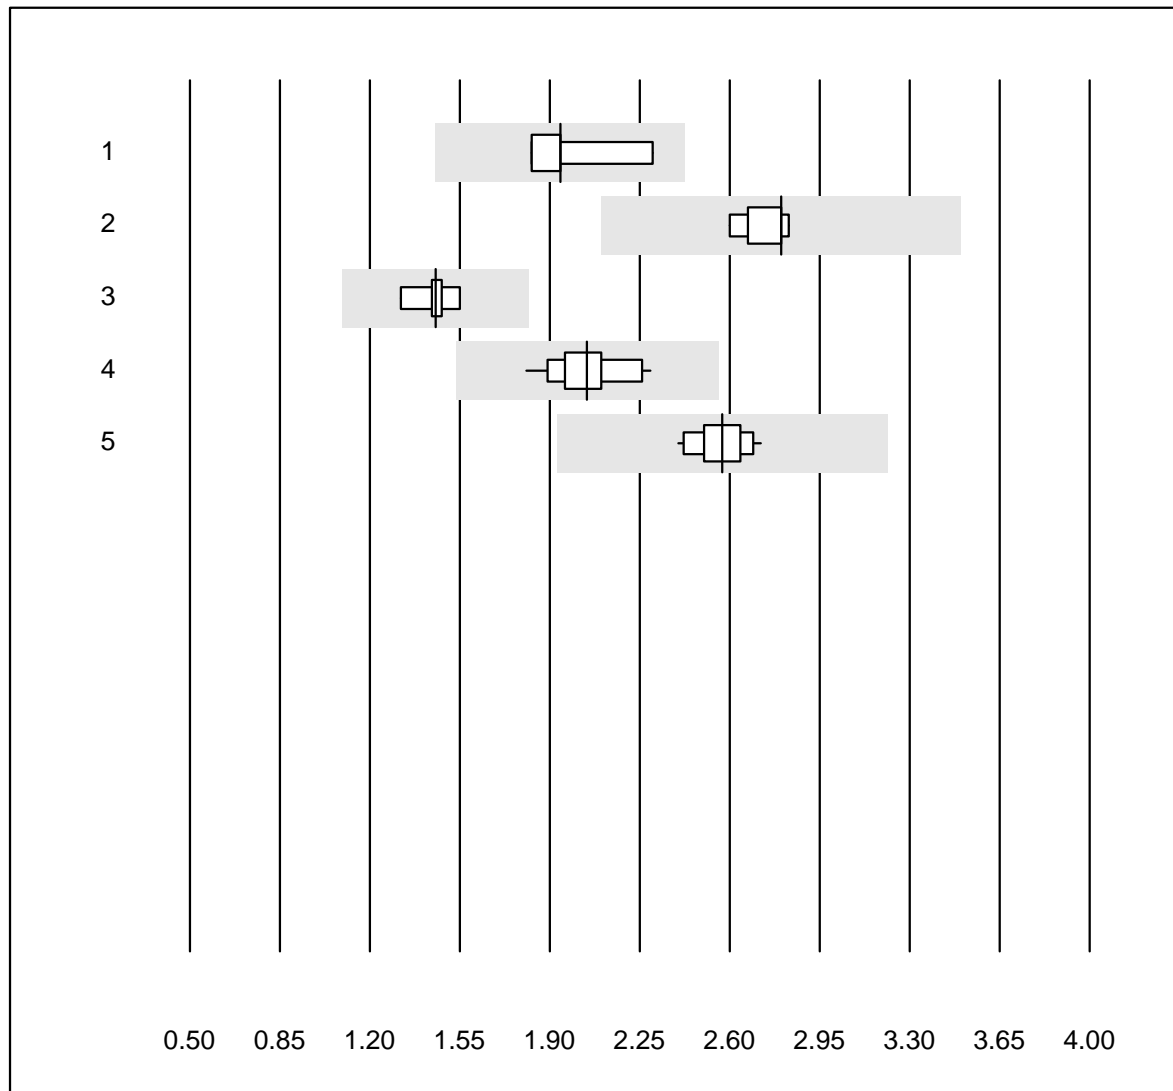


Tolérance MQ : 25 %

LDL Cholesterin (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	5	80.0	0.0	20.0	1.9	11.0	e*
2	Roche, Cobas	8	100.0	0.0	0.0	2.8	2.9	e
3	Hitachi S40/M40	6	100.0	0.0	0.0	1.5	5.2	e
4	Autolyser/DiaSys	13	100.0	0.0	0.0	2.0	6.7	e
5	Beckman	11	100.0	0.0	0.0	2.6	4.0	e

Fer

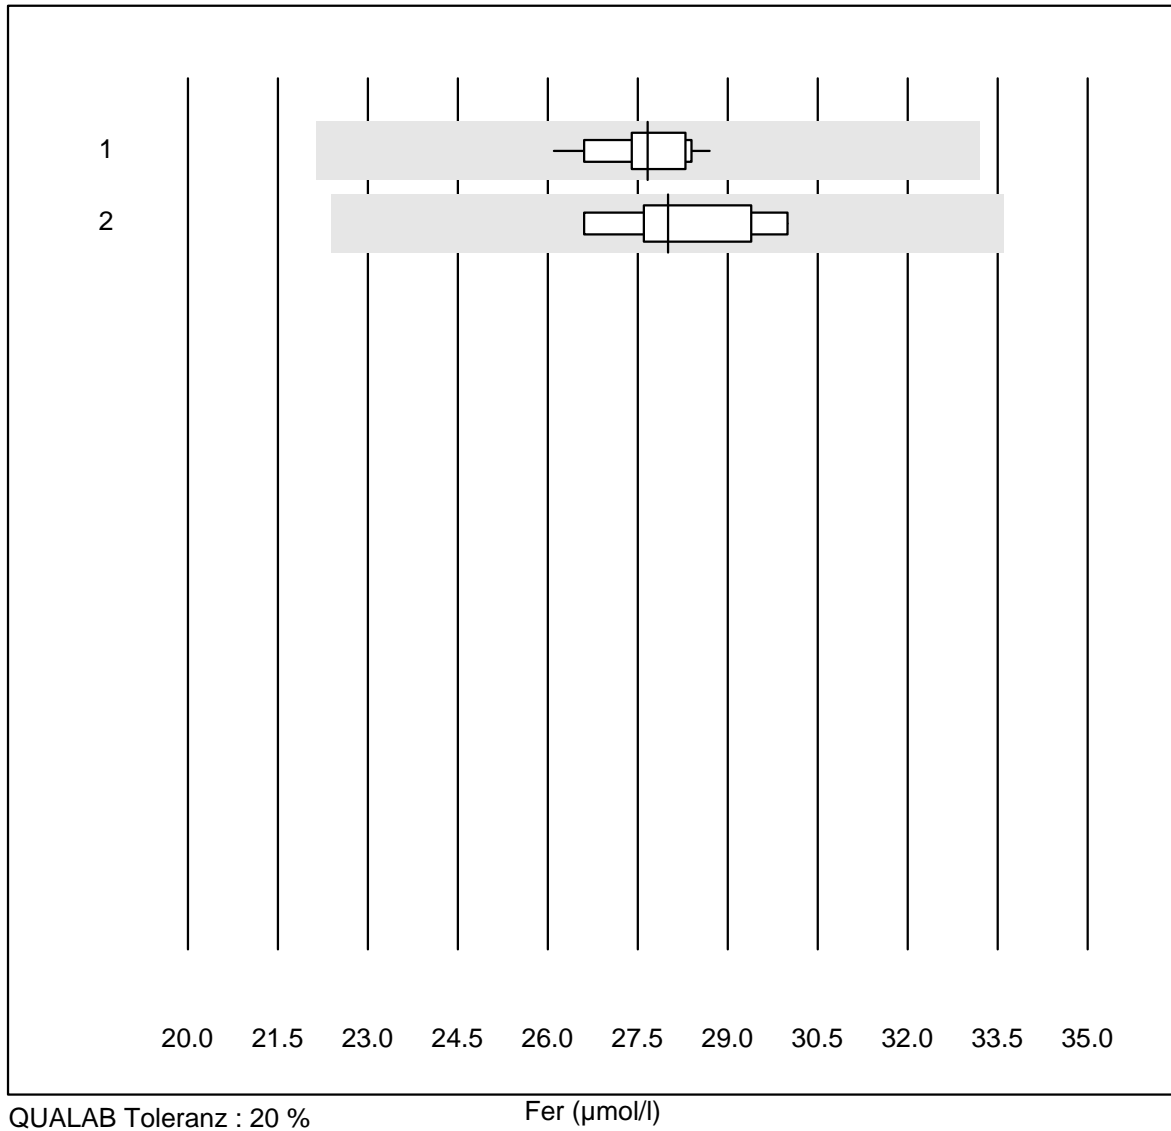


QUALAB Toleranz : 20 %

Fer (µmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	21	100.0	0.0	0.0	28	2.8	e
2	Cobas	9	100.0	0.0	0.0	28	4.2	e

Gamma-GT

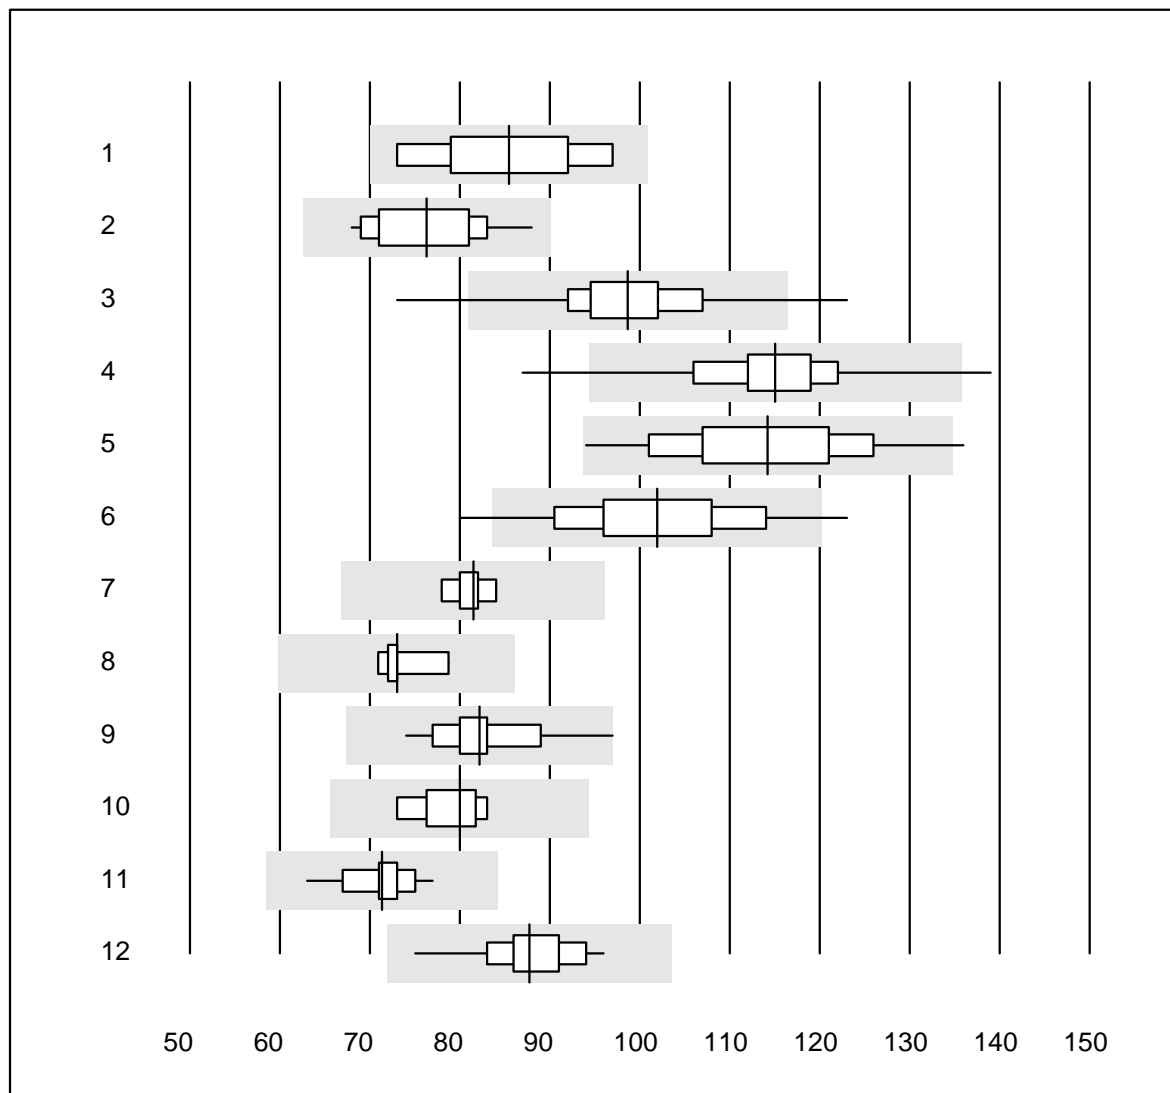


QUALAB Toleranz : 18 %

Gamma-GT (U/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	6	100.0	0.0	0.0	86	10.1	e*
2 Cobas	19	100.0	0.0	0.0	76	7.2	e
3 Reflotron	689	97.6	1.2	1.2	99	6.2	e
4 Fuji Dri-Chem	861	98.6	0.6	0.8	115	5.5	e
5 Spotchem/Ready	92	96.7	3.3	0.0	114	8.4	e
6 Spotchem D-Concept	288	96.9	2.8	0.3	102	8.6	e
7 Selectra/Biolis	6	100.0	0.0	0.0	82	2.5	e
8 Architect	6	100.0	0.0	0.0	73	3.7	e
9 Dimension	13	92.3	7.7	0.0	82	7.1	e
10 IFCC Beckmann	7	100.0	0.0	0.0	80	4.4	e
11 Piccolo	41	100.0	0.0	0.0	71	4.4	e
12 Hitachi S40/M40	14	100.0	0.0	0.0	88	5.9	e
13 Autolyser/DiaSys	17	100.0	0.0	0.0	81	3.9	e

Glucose

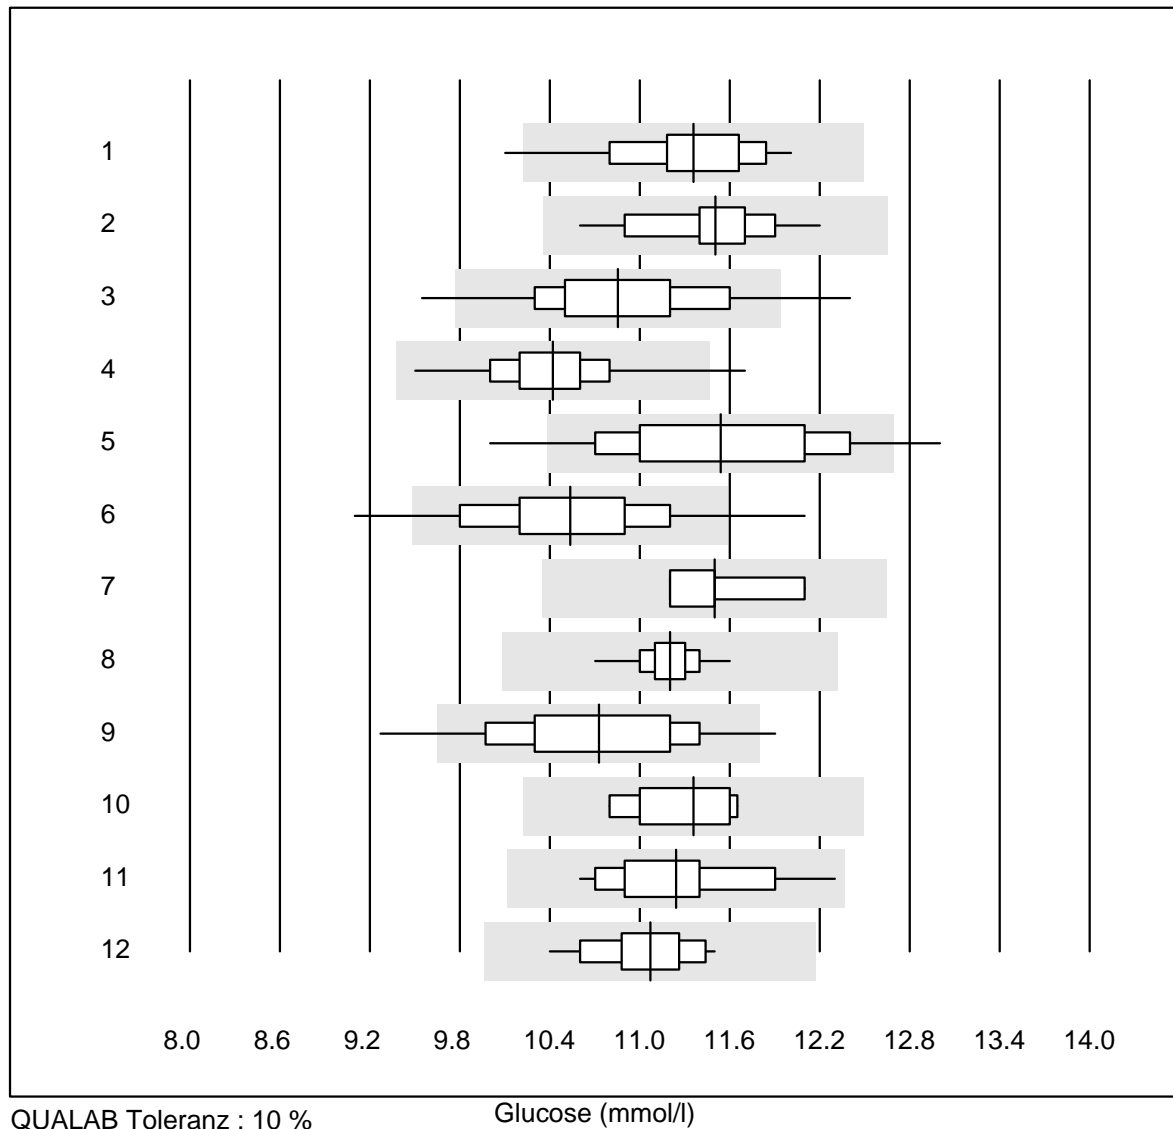


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	34	97.1	2.9	0.0	11.4	3.6	e
2	Cobas	18	100.0	0.0	0.0	11.5	3.2	e
3	Reflotron	682	94.8	2.6	2.6	10.9	4.7	e
4	Fuji Dri-Chem	816	99.7	0.2	0.1	10.4	2.9	e
5	Spotchem/Ready	82	90.3	7.3	2.4	11.5	5.8	e
6	Spotchem D-Concept	267	92.2	6.7	1.1	10.5	5.3	e
7	Dimension	4	100.0	0.0	0.0	11.5	3.3	e*
8	Piccolo	55	100.0	0.0	0.0	11.2	1.6	e
9	Cholestech LDX	108	95.4	3.7	0.9	10.7	5.2	e
10	Abx Mira	7	100.0	0.0	0.0	11.4	2.9	e
11	Hitachi S40/M40	16	100.0	0.0	0.0	11.2	4.0	e
12	Autolyser/DiaSys	17	100.0	0.0	0.0	11.1	2.9	e
13	iStat Chem8	6	100.0	0.0	0.0	10.4	1.7	e

Glucose

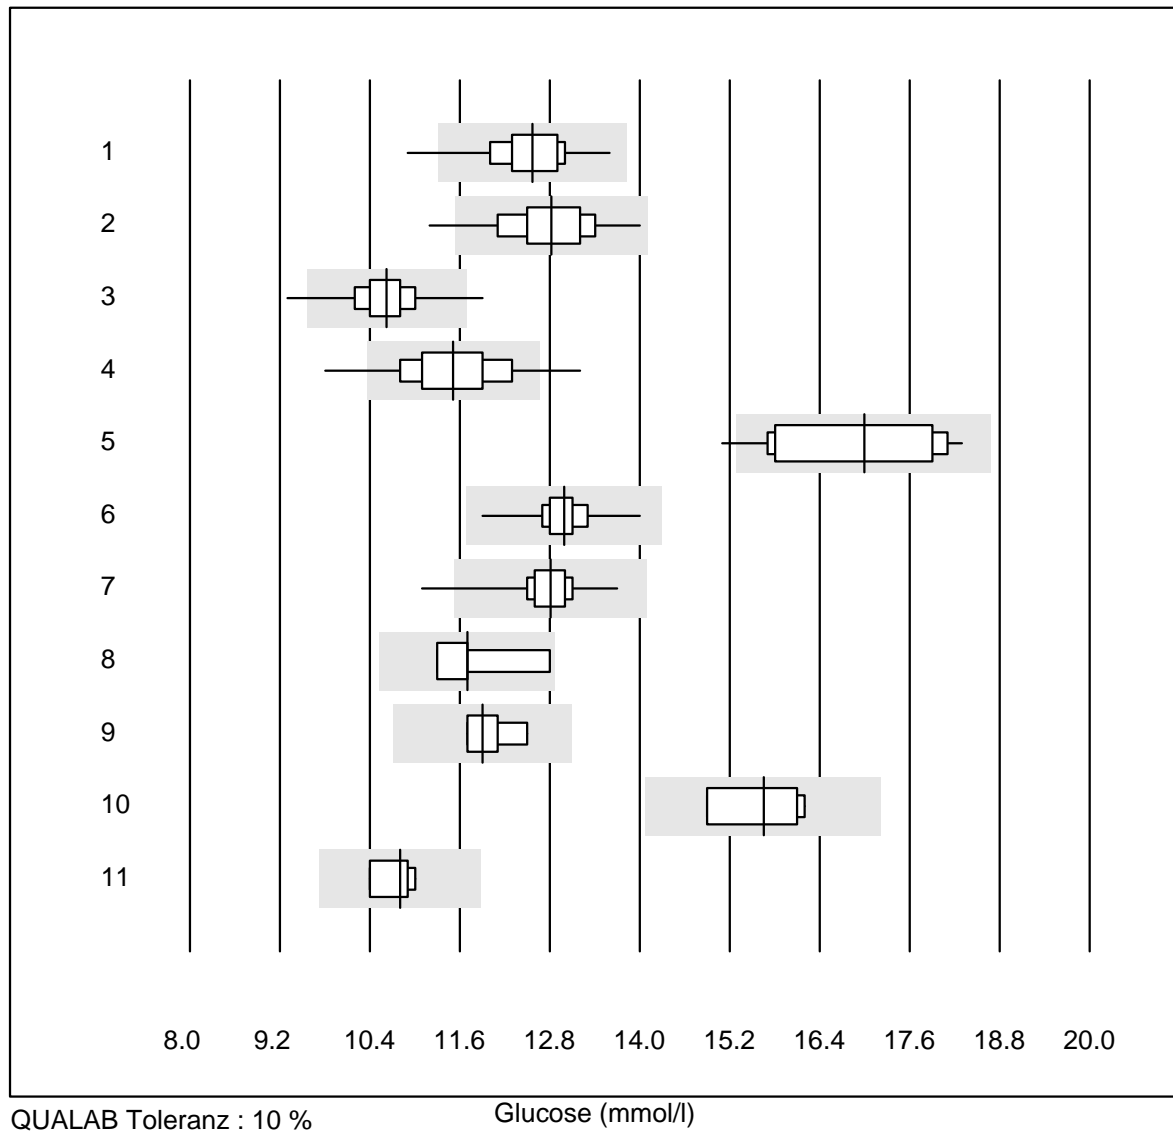


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Accu-Chek Aviva	311	88.1	2.9	9.0	12.6	3.8	e
2	Accu-Chek Inform 2	409	98.8	1.0	0.2	12.8	3.8	e
3	Accu-Check Guide	172	95.9	2.9	1.2	10.6	3.6	e
4	Contour XT	1088	93.4	5.4	1.2	11.5	5.1	e
5	Glucocard	17	82.3	5.9	11.8	17.0	6.3	e*
6	Hemocue 201+ P-equiv	95	97.9	0.0	2.1	13.0	2.3	e
7	Hemocue 201RT P-equiv	84	92.8	1.2	6.0	12.8	2.7	e
8	FreeStyle Precision	4	100.0	0.0	0.0	11.7	5.4	e*
9	Freestyle Freedom li	5	100.0	0.0	0.0	11.9	2.8	e*
10	Sanofi BG Star	4	100.0	0.0	0.0	15.7	4.2	e*
11	Contour NEXT ONE	4	100.0	0.0	0.0	10.8	2.5	e*

Glucose

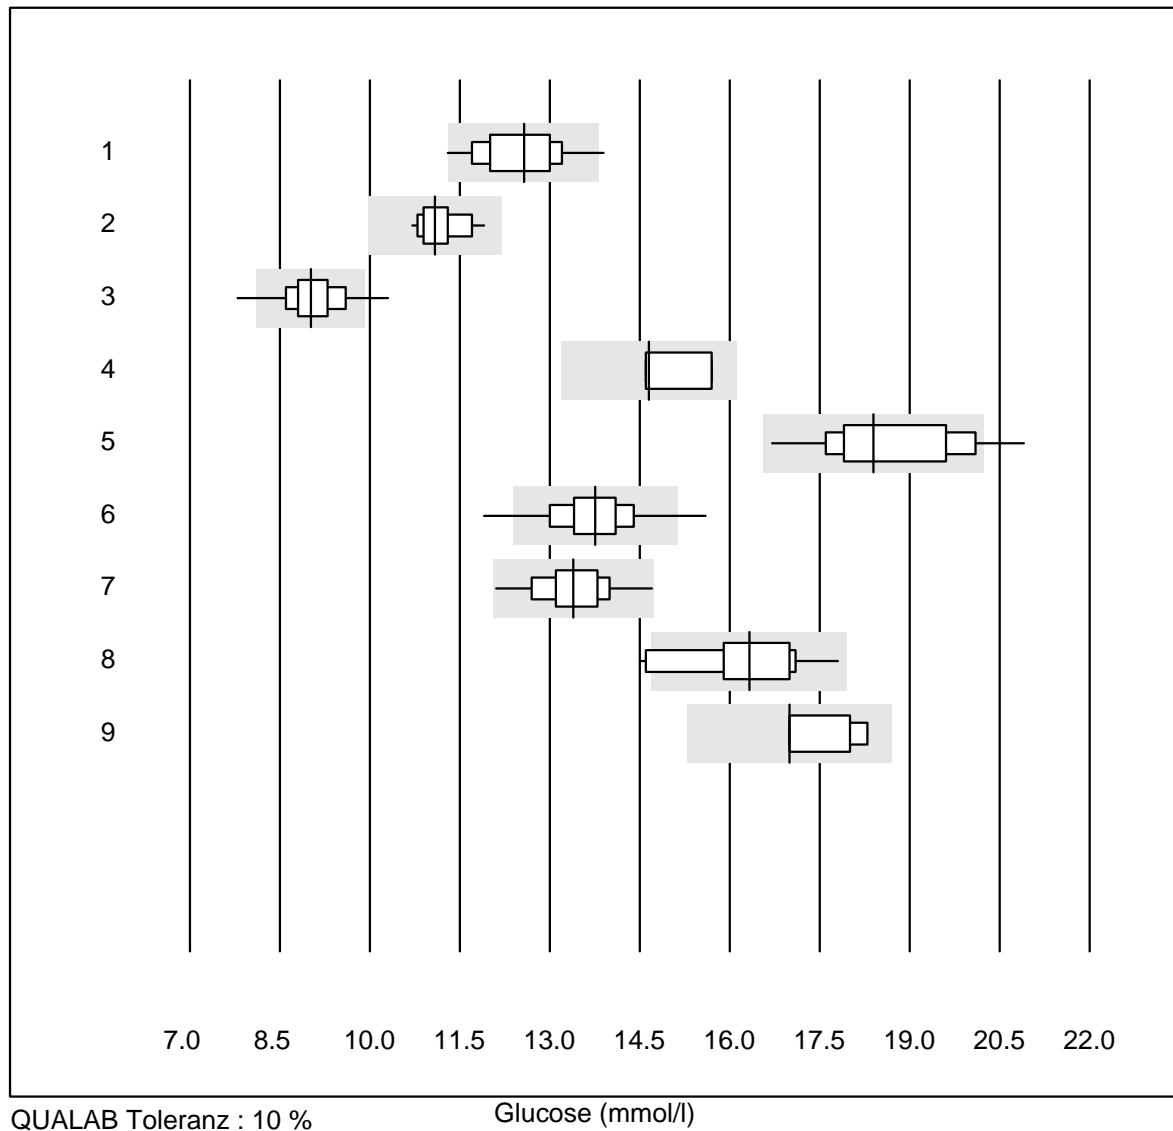


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Hemocue 201+ (alt)	44	95.5	4.5	0.0	12.6	4.9	e
2	OneTouch Verio	29	100.0	0.0	0.0	11.1	2.7	e
3	Contour 2 (5s)	25	80.0	8.0	12.0	9.0	5.4	e
4	Contour (15s)	6	50.0	0.0	50.0	14.7	4.1	e*
5	Healthpro	47	83.0	8.5	8.5	18.4	5.6	e
6	Mylife UNIO	244	98.0	1.6	0.4	13.8	4.0	e
7	mylife Pura	74	100.0	0.0	0.0	13.4	4.1	e
8	Omnitest	16	81.2	12.5	6.3	16.3	5.6	e*
9	Alpha Check	7	57.1	0.0	42.9	17.0	3.7	e*

Acide urique

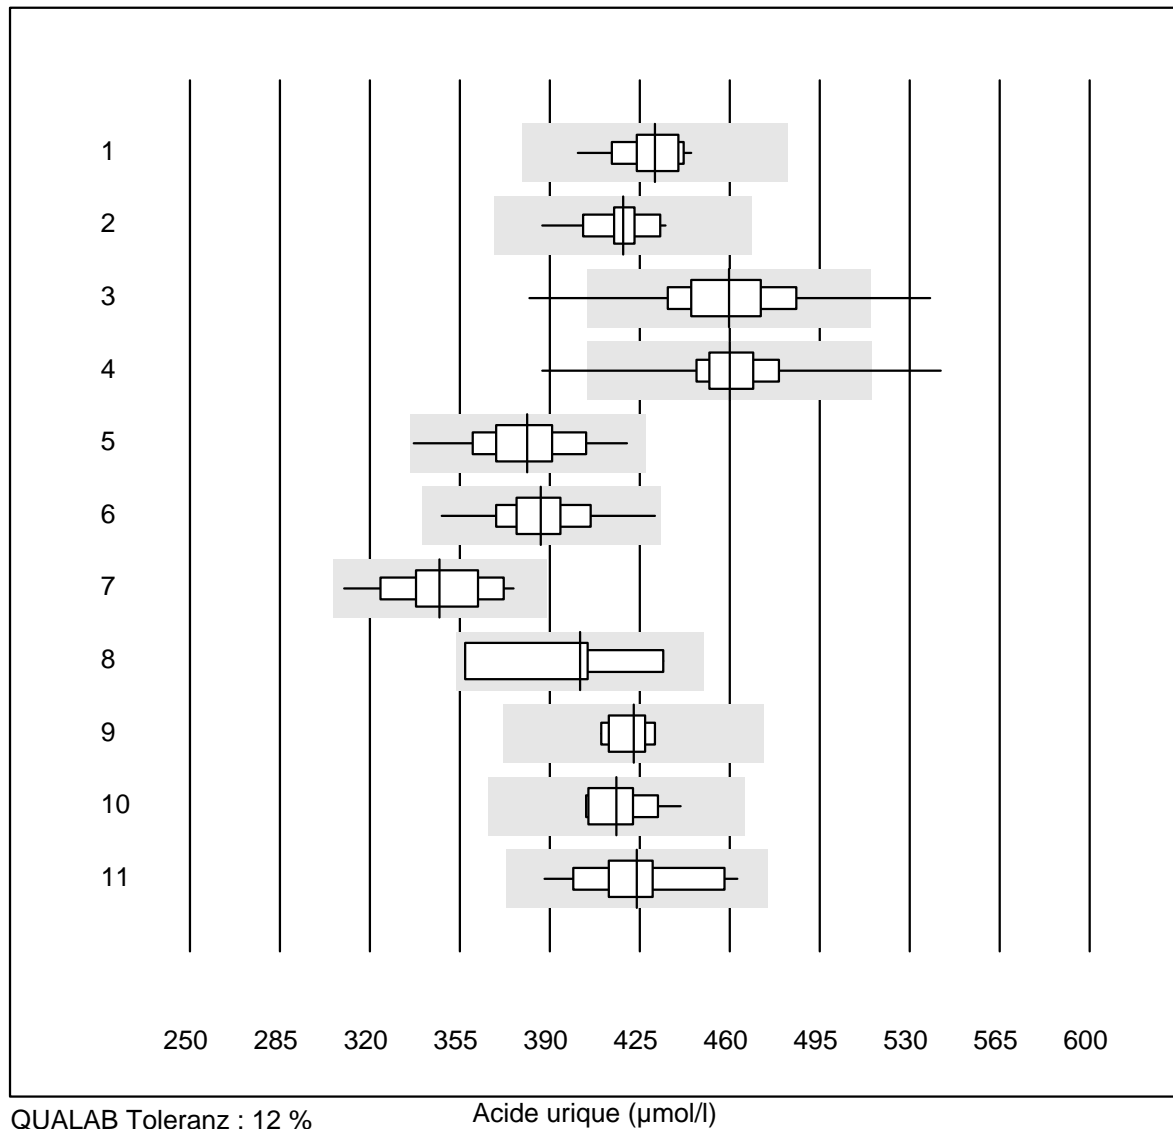


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	31	96.8	0.0	3.2	431	2.5	e
2	Cobas	16	100.0	0.0	0.0	418	2.7	e
3	Reflotron	612	96.6	2.1	1.3	460	4.6	e
4	Fuji Dri-Chem	808	98.5	0.9	0.6	460	3.1	e
5	Spotchem/Ready	72	100.0	0.0	0.0	381	4.4	e
6	Spotchem D-Concept	269	99.6	0.0	0.4	387	3.7	e
7	Piccolo	29	100.0	0.0	0.0	347	4.9	e
8	Skyla	4	100.0	0.0	0.0	402	8.0	e*
9	Abx Mira	6	100.0	0.0	0.0	423	2.0	e
10	Hitachi S40/M40	14	92.9	0.0	7.1	416	2.8	e
11	Autolyser/DiaSys	16	100.0	0.0	0.0	424	4.5	e

Urée

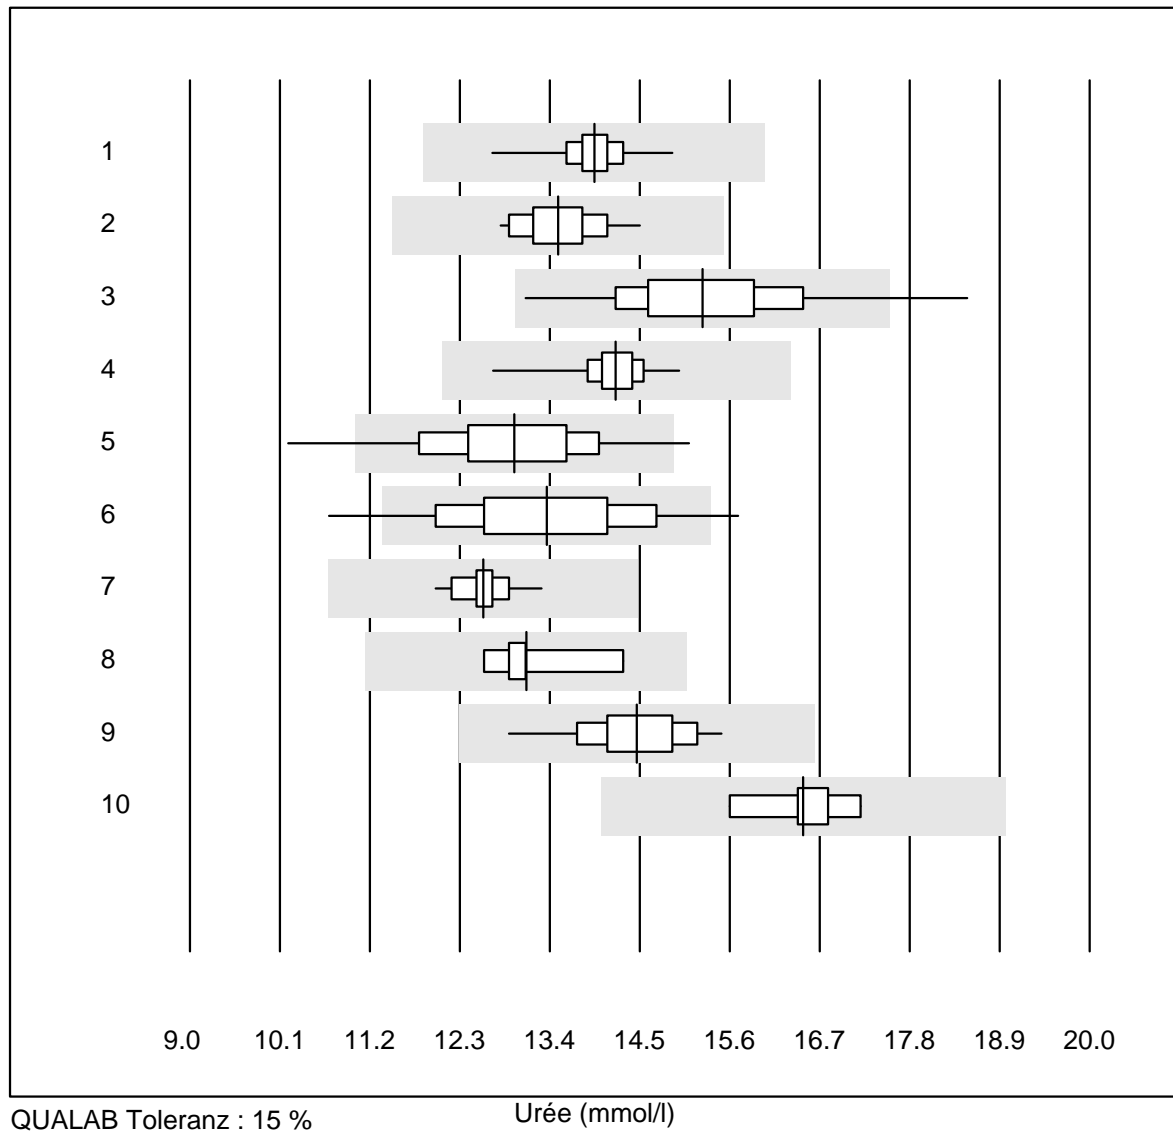


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	32	100.0	0.0	0.0	13.9	2.9	e
2	Cobas	17	100.0	0.0	0.0	13.5	3.3	e
3	Reflotron	272	97.8	1.1	1.1	15.3	6.1	e
4	Fuji Dri-Chem	482	99.6	0.0	0.4	14.2	2.2	e
5	Spotchem/Ready	50	94.0	6.0	0.0	13.0	7.3	e
6	Spotchem D-Concept	164	92.7	4.3	3.0	13.4	7.7	e
7	Piccolo	52	94.2	0.0	5.8	12.6	2.0	e
8	Hitachi S40/M40	10	90.0	0.0	10.0	13.1	3.8	e
9	Autolyser/DiaSys	13	100.0	0.0	0.0	14.5	4.8	e
10	iStat Chem8	5	100.0	0.0	0.0	16.5	3.6	e

Potassium

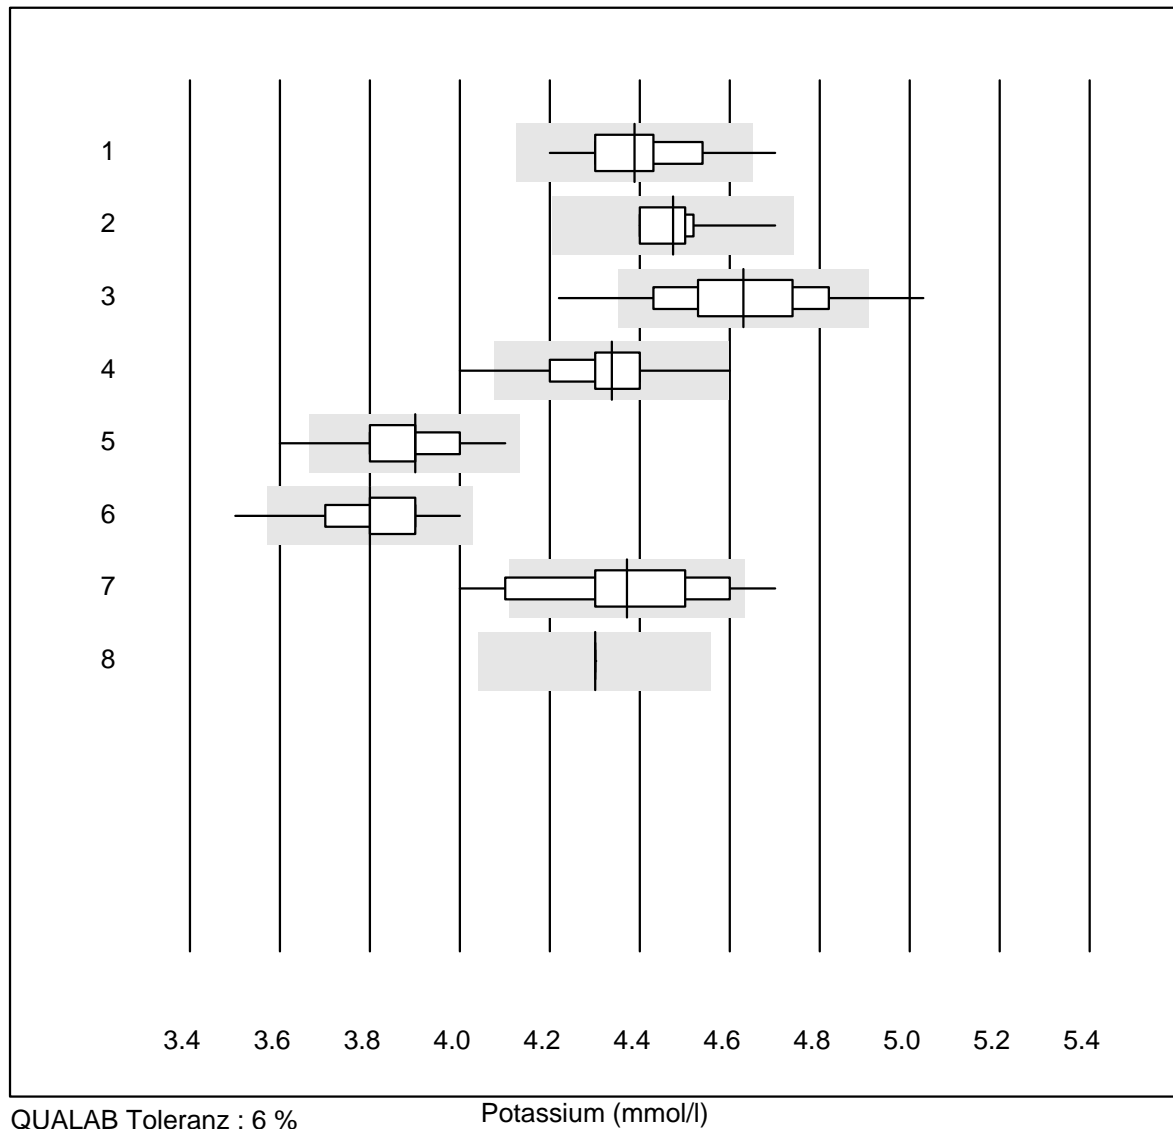


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 ISE	47	95.8	2.1	2.1	4.39	2.4	e
2 Cobas	20	100.0	0.0	0.0	4.47	1.7	e
3 Reflotron	618	90.3	5.7	4.0	4.63	3.2	e
4 Fuji Dri-Chem	848	97.1	1.1	1.8	4.34	2.0	e
5 Spotchem D-Concept	268	98.2	0.7	1.1	3.90	2.3	e
6 Spotchem EL-SE 1520	80	97.4	1.3	1.3	3.80	2.4	e
7 Piccolo	43	72.1	16.3	11.6	4.37	4.0	e
8 iStat Chem8	7	100.0	0.0	0.0	4.30	0.0	e

Créatinine

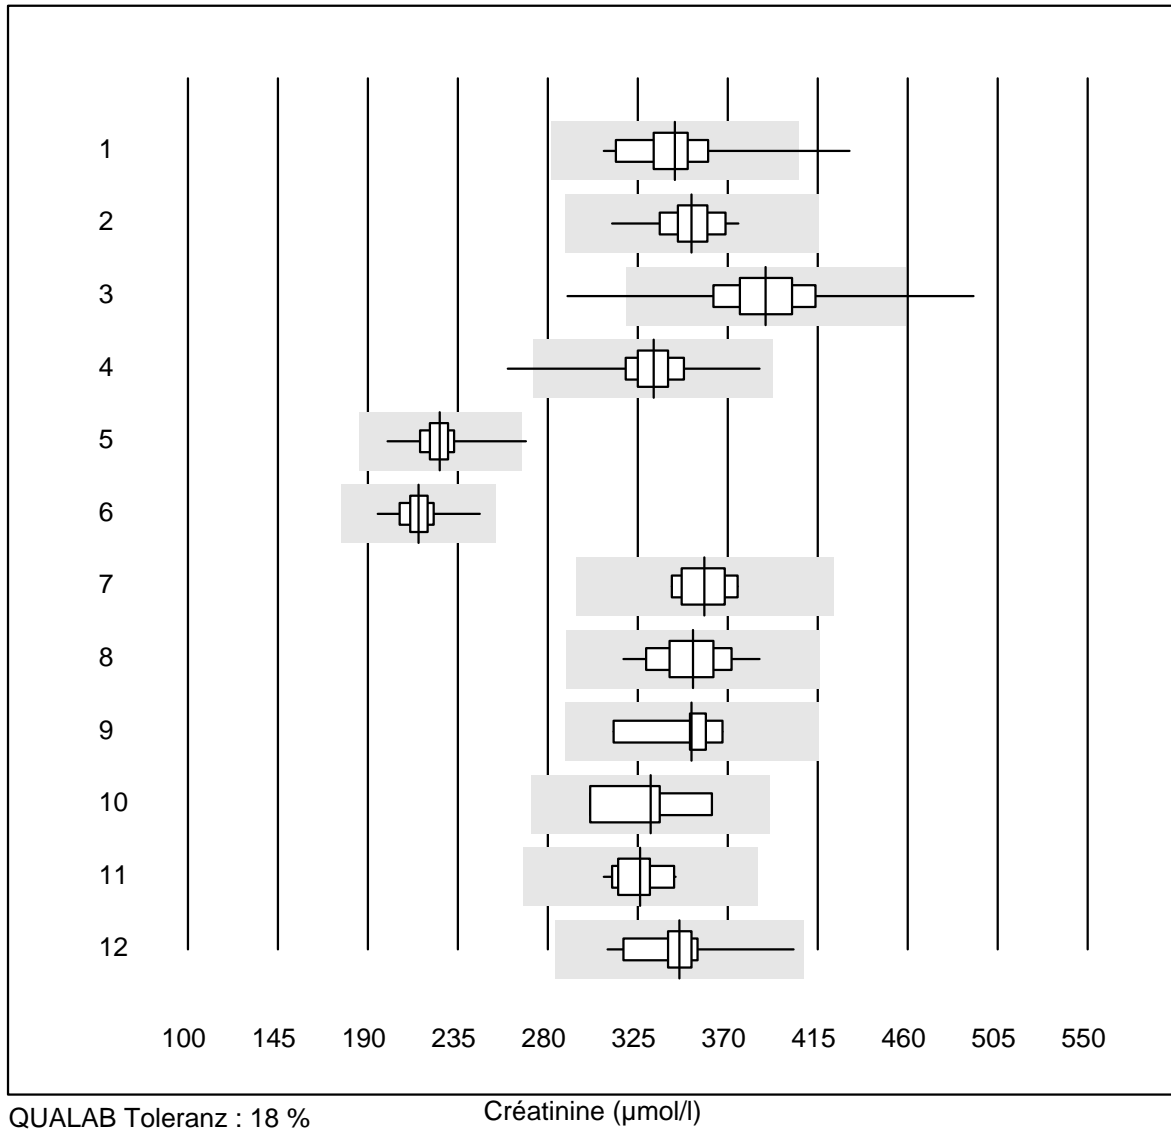

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	20	95.0	5.0	0.0	344	7.3	e
2	Cobas	21	100.0	0.0	0.0	352	4.2	e
3	Reflotron	800	97.4	1.5	1.1	389	6.1	e
4	Fuji Dri-Chem	882	99.3	0.1	0.6	333	3.6	e
5	Spotchem/Ready	101	98.0	2.0	0.0	226	4.1	e
6	Spotchem D-Concept	284	99.6	0.0	0.4	215	3.4	e
7	Enzymatisch	9	100.0	0.0	0.0	358	3.5	e
8	Piccolo	55	100.0	0.0	0.0	352	4.3	e
9	Abx Mira	9	100.0	0.0	0.0	352	4.5	e
10	Skyla	4	100.0	0.0	0.0	331	7.6	e*
11	Hitachi S40/M40	17	94.1	0.0	5.9	326	3.2	e
12	Autolyser/DiaSys	17	100.0	0.0	0.0	346	5.8	e

Créatinine E

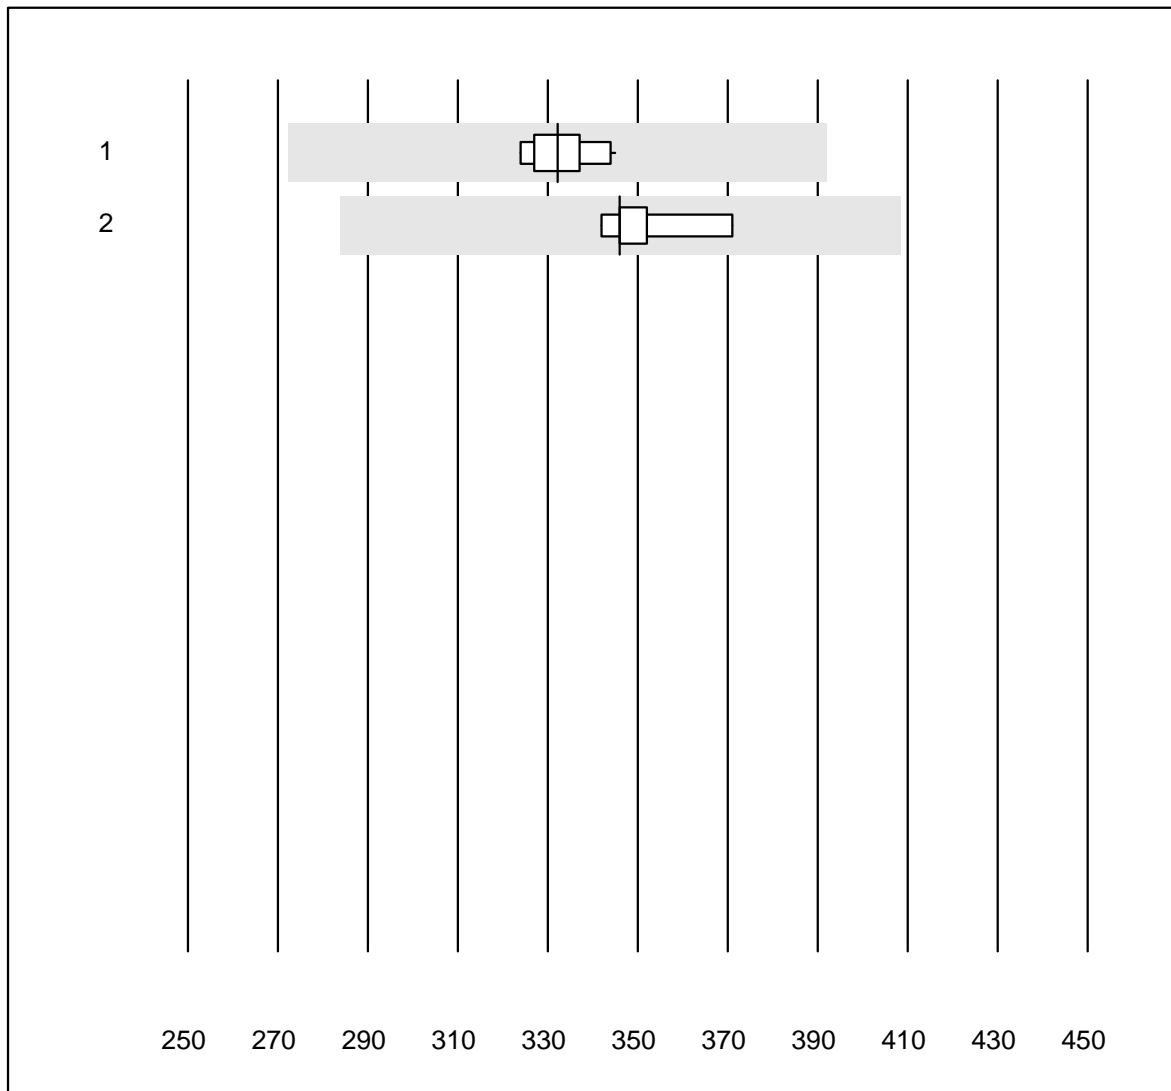


QUALAB Toleranz : 18 %

Créatinine E (µmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	iStat Chem8	10	100.0	0.0	0.0	332	2.2	e
2	ABL700/800	9	100.0	0.0	0.0	346	2.5	e

eGFR CKD-EPI

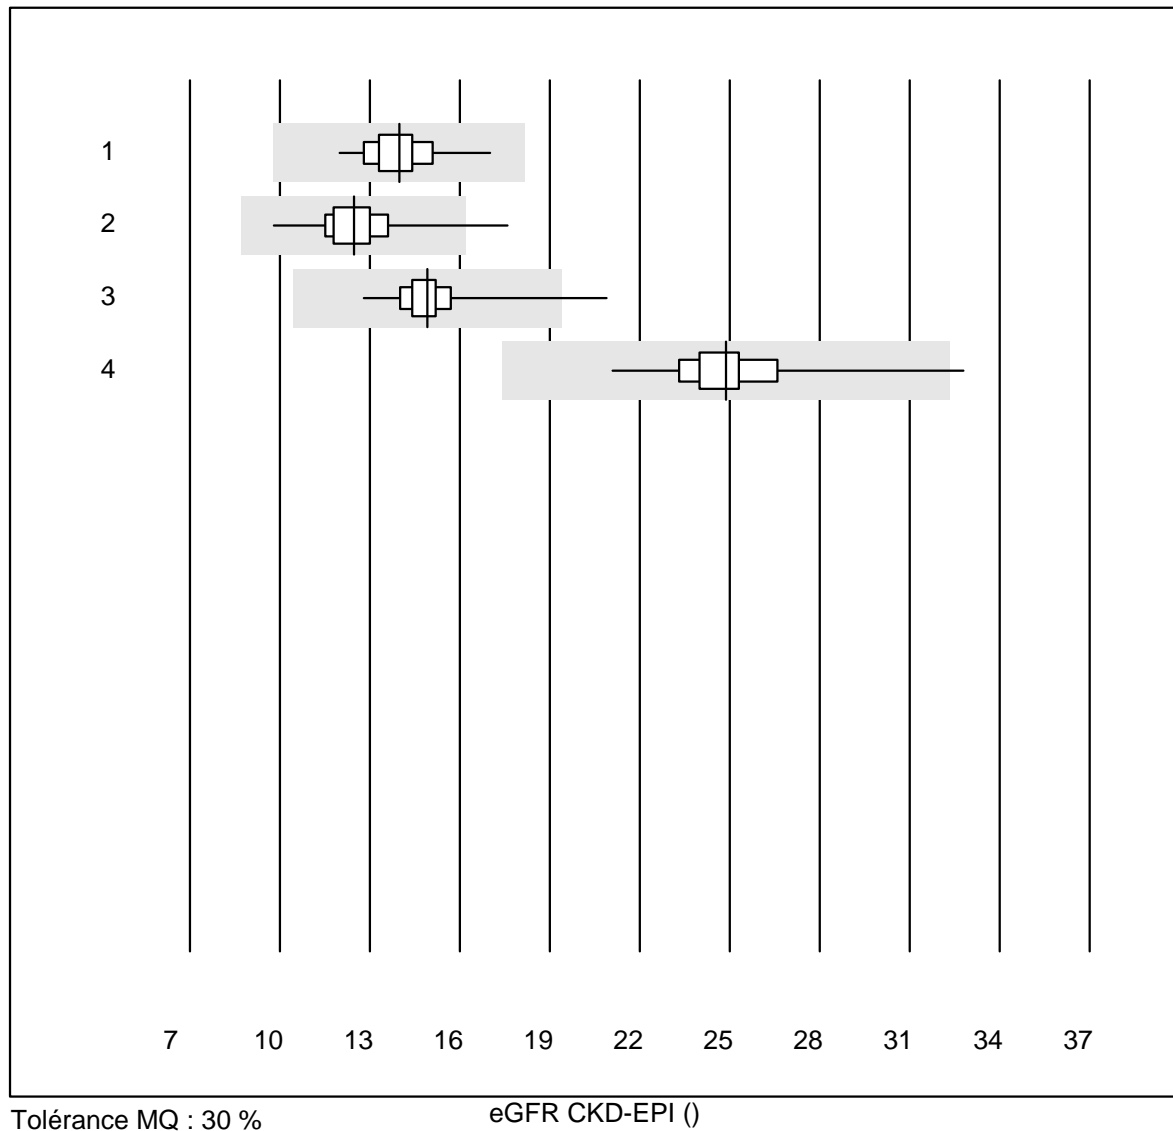


Tolérance MQ : 30 %

eGFR CKD-EPI ()


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	69	95.7	0.0	4.3	14	6.6	e
2	Reflotron	282	95.7	1.8	2.5	12	8.5	e
3	Fuji Dri-Chem	363	96.4	1.1	2.5	15	6.4	e
4	Spotchem/Ready	140	95.7	0.7	3.6	25	6.4	e

eGFR Cockcroft-Gault

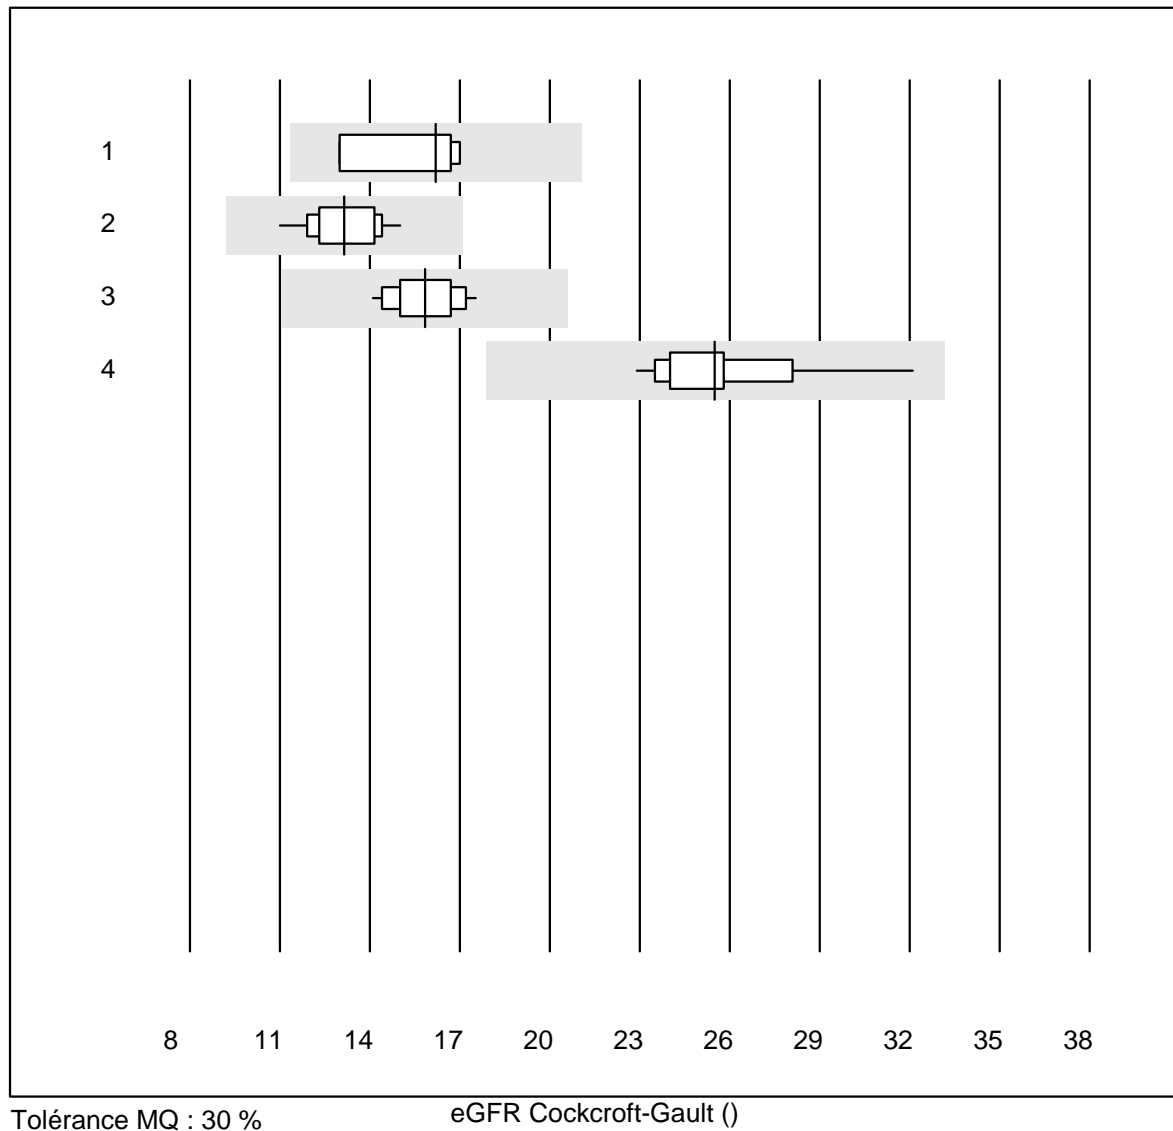


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	4	100.0	0.0	0.0	16	11.7	e*
2	Reflotron	25	92.0	0.0	8.0	13	7.9	e
3	Fuji Dri-Chem	30	96.7	0.0	3.3	16	6.4	e
4	Spotchem/Ready	15	100.0	0.0	0.0	25	9.0	e

eGFR MDRD

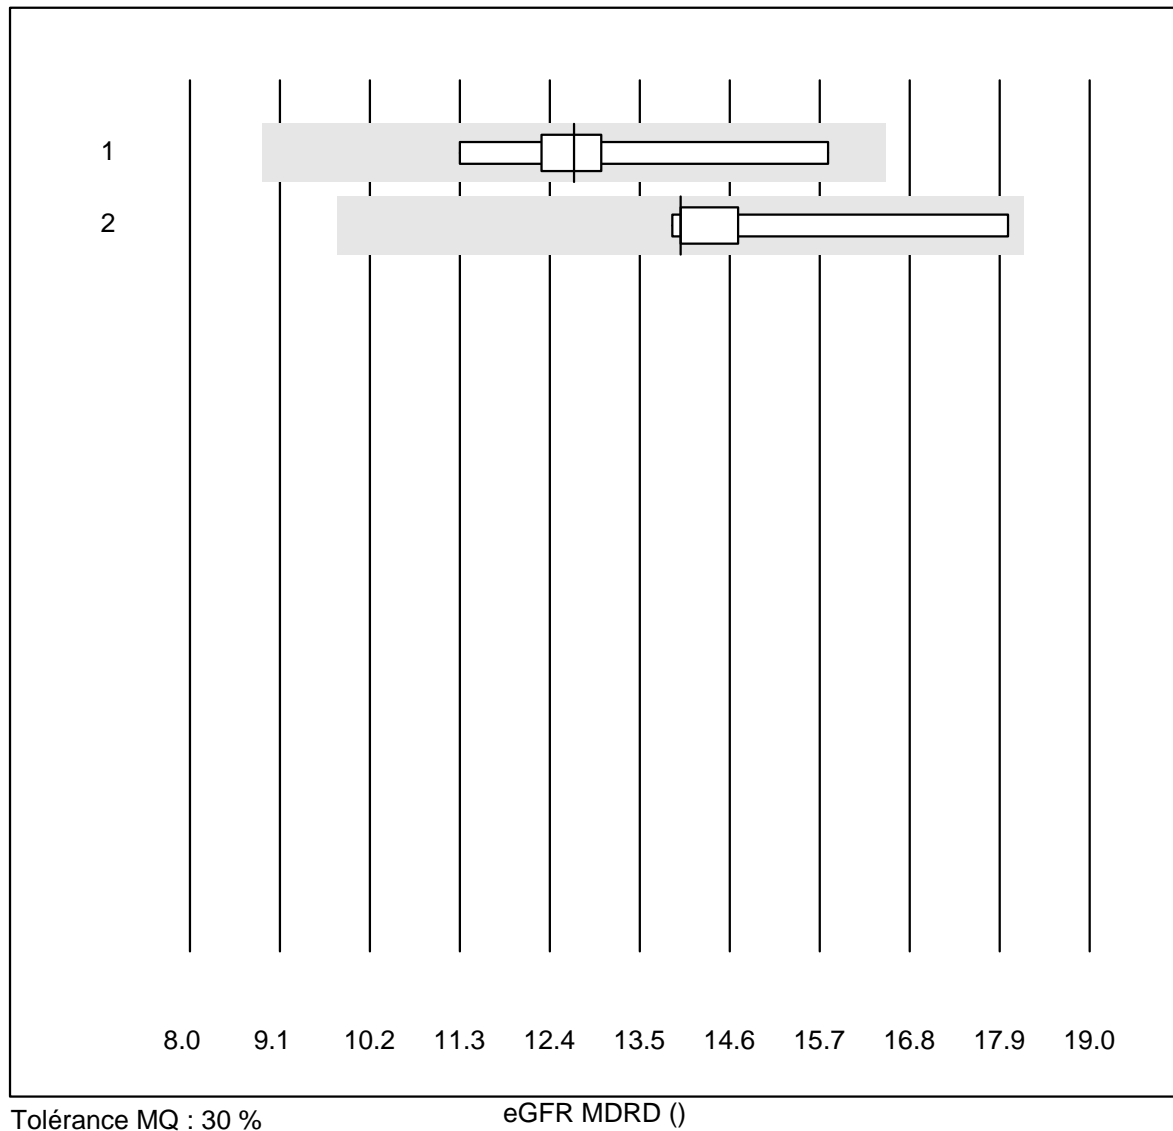


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Reflotron	5	100.0	0.0	0.0	13	12.9	e*
2	Fuji Dri-Chem	5	100.0	0.0	0.0	14	11.7	e*

LDH

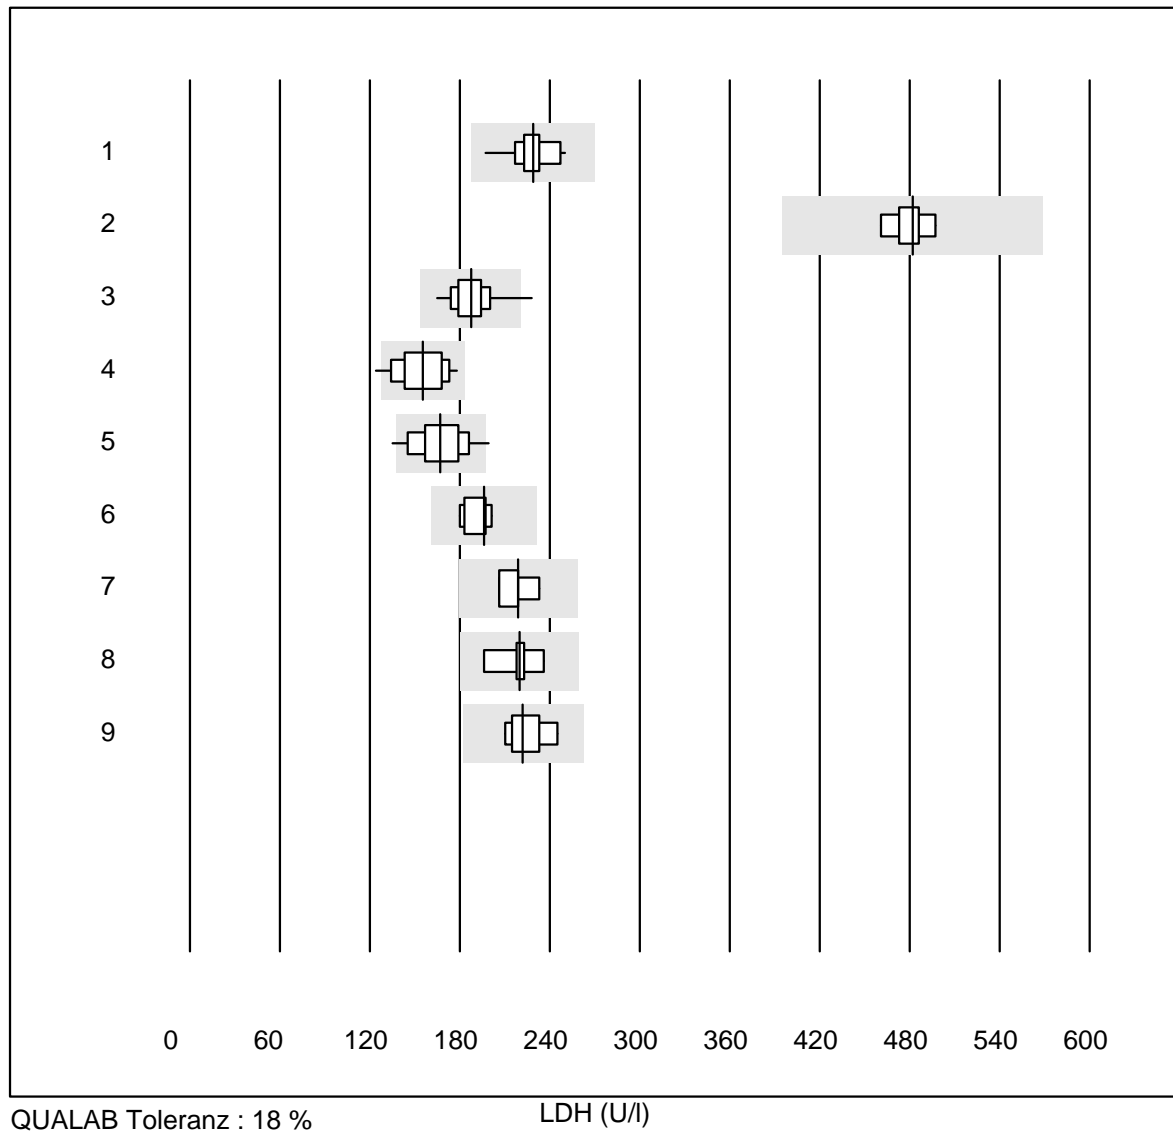

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	37	100.0	0.0	0.0	229	4.7	e
2 Cobas	9	100.0	0.0	0.0	482	2.2	e
3 Fuji Dri-Chem	150	98.7	1.3	0.0	187	5.8	e
4 Spotchem/Ready	13	92.3	7.7	0.0	155	10.8	e*
5 Spotchem D-Concept	50	86.0	4.0	10.0	167	8.9	e
6 Piccolo	6	100.0	0.0	0.0	196	4.4	e
7 Abx Mira	5	80.0	0.0	20.0	219	5.1	e*
8 Hitachi S40/M40	5	100.0	0.0	0.0	220	6.6	e*
9 Autolyser/DiaSys	9	100.0	0.0	0.0	222	5.5	e

Magnésium

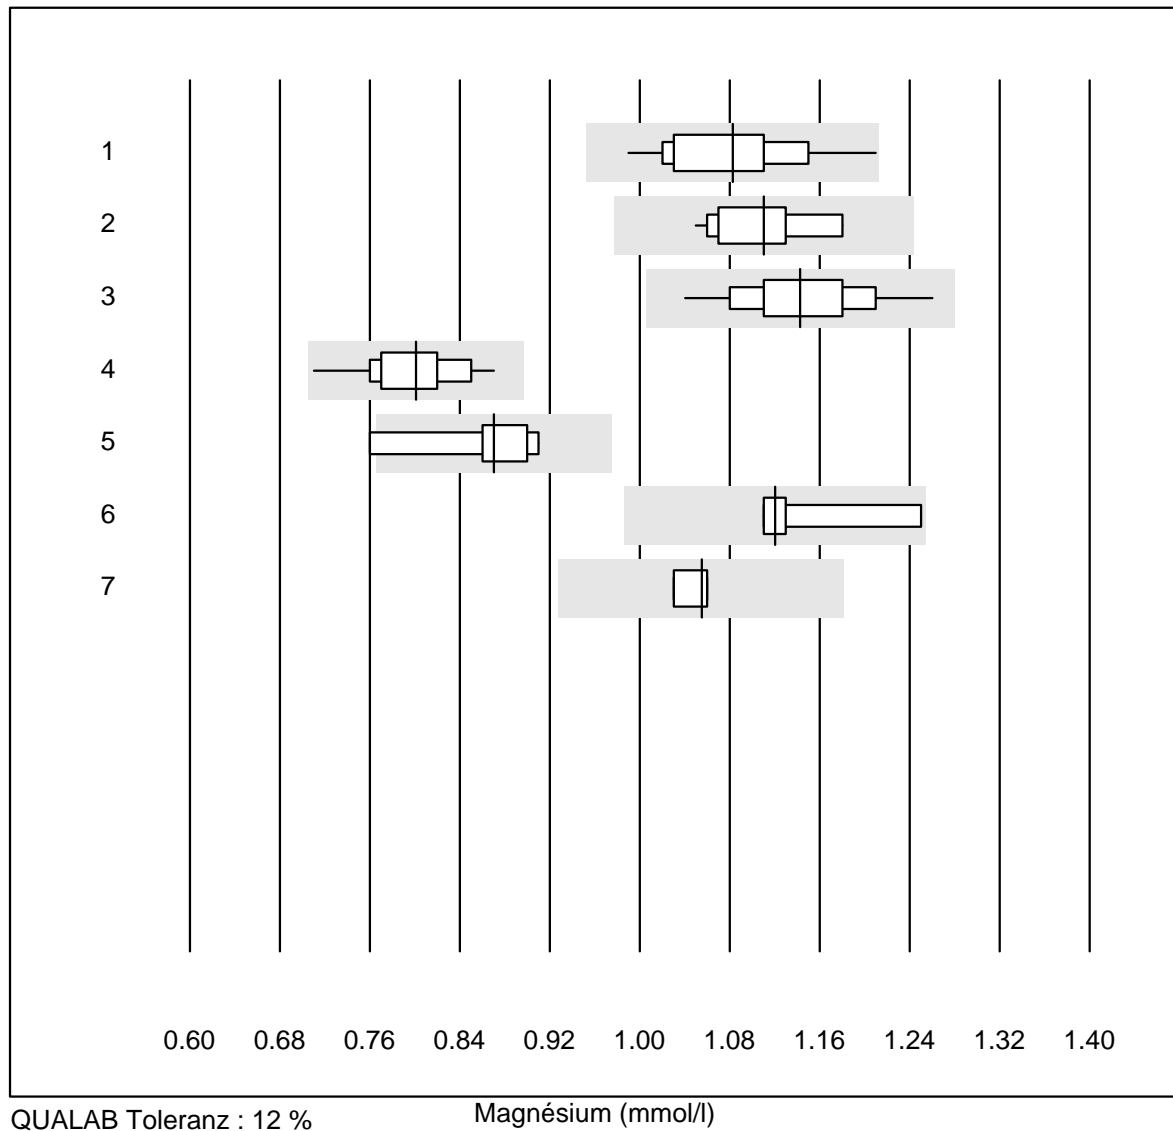


QUALAB Toleranz : 12 %

Magnésium (mmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	16	100.0	0.0	0.0	1.08	5.1	e
2	Cobas	13	100.0	0.0	0.0	1.11	3.8	e
3	Fuji Dri-Chem	115	98.3	0.0	1.7	1.14	4.4	e
4	Spotchem D-Concept	46	100.0	0.0	0.0	0.80	4.4	e
5	Spotchem/Ready	5	80.0	20.0	0.0	0.87	6.9	e*
6	Beckman	8	100.0	0.0	0.0	1.12	4.4	e*
7	Piccolo	8	87.5	0.0	12.5	1.06	1.3	e

Sodium

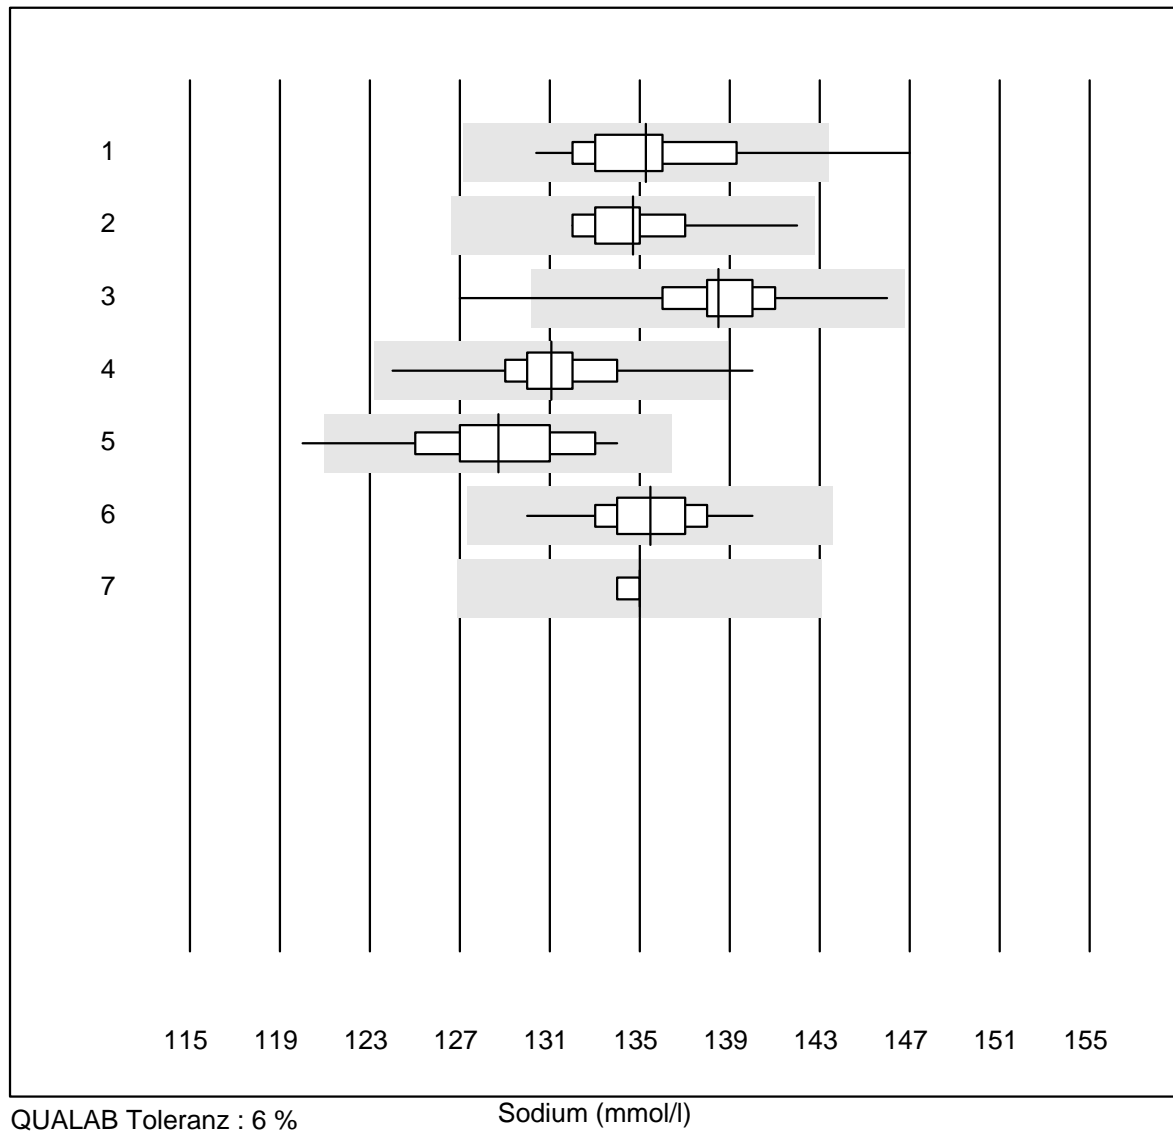

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 ISE	44	97.7	2.3	0.0	135	2.4	e
2 Cobas	20	100.0	0.0	0.0	135	1.8	e
3 Fuji Dri-Chem	791	97.7	0.9	1.4	138	1.6	e
4 Spotchem D-Concept	257	98.4	0.4	1.2	131	1.8	e
5 Spotchem EL-SE 1520	79	98.7	1.3	0.0	129	2.2	e
6 Piccolo	43	97.7	0.0	2.3	135	1.6	e
7 iStat Chem8	5	100.0	0.0	0.0	135	0.3	e

Phosphates

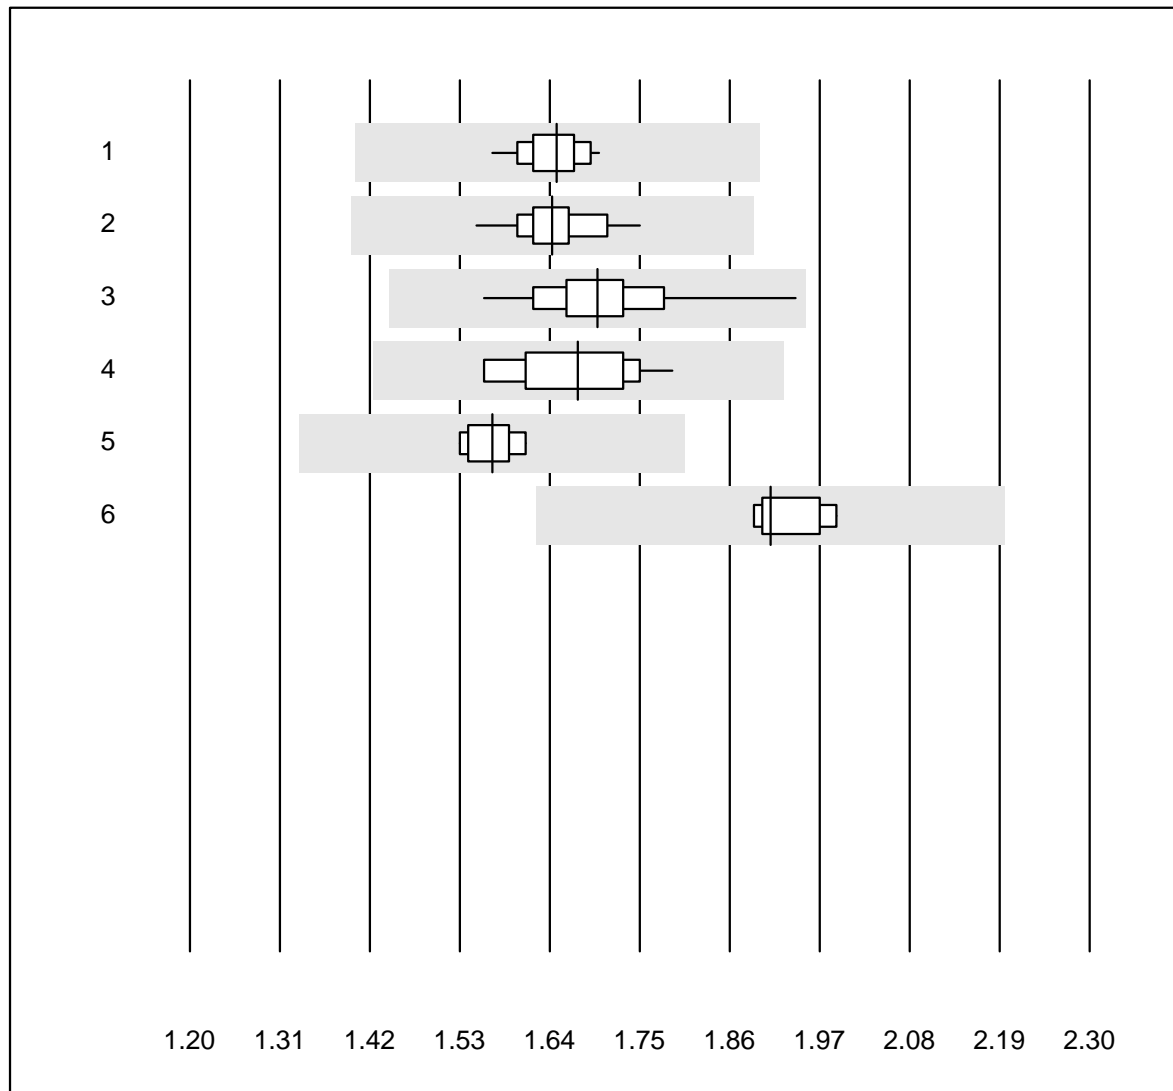


QUALAB Toleranz : 15 %

Phosphates (mmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	25	100.0	0.0	0.0	1.6	2.1	e
2	Cobas	14	100.0	0.0	0.0	1.6	3.0	e
3	Fuji Dri-Chem	83	100.0	0.0	0.0	1.7	3.9	e
4	Spotchem D-Concept	20	100.0	0.0	0.0	1.7	4.3	e
5	Spotchem/Ready	5	100.0	0.0	0.0	1.6	2.1	e
6	Piccolo	6	100.0	0.0	0.0	1.9	2.1	e

Protéine

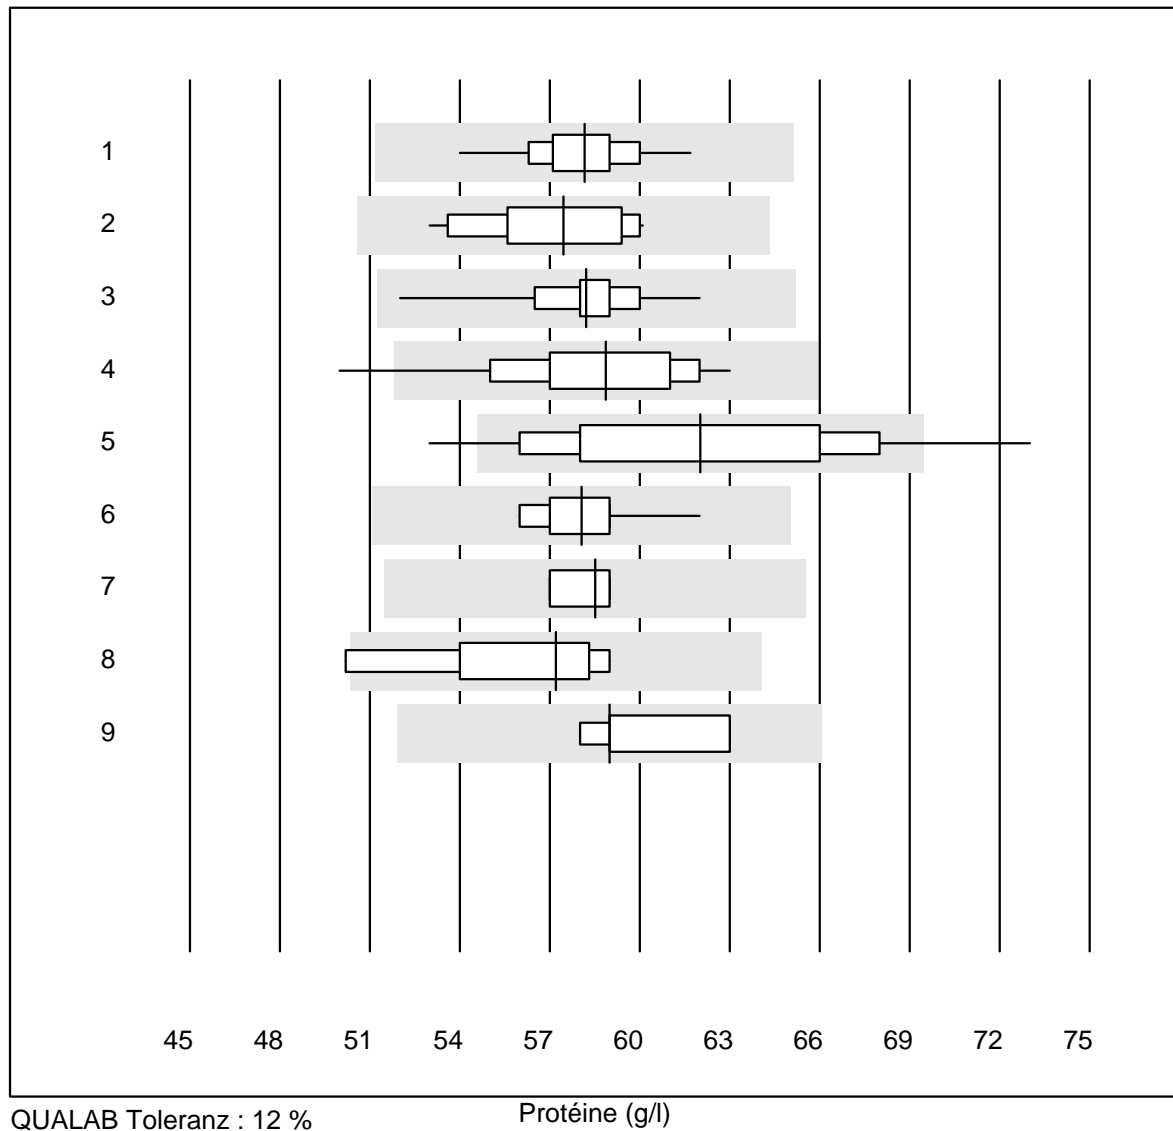

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	27	100.0	0.0	0.0	58.2	2.6	e
2	Cobas	15	100.0	0.0	0.0	57.5	4.0	e
3	Fuji Dri-Chem	183	100.0	0.0	0.0	58.2	2.6	e
4	Spotchem/Ready	28	96.4	3.6	0.0	58.9	5.3	e
5	Spotchem D-Concept	106	91.6	7.5	0.9	62.0	7.3	e
6	Piccolo	41	95.1	0.0	4.9	58.1	2.3	e
7	Skyla	4	100.0	0.0	0.0	58.5	1.6	e
8	Abx Mira	5	80.0	20.0	0.0	57.2	6.5	e*
9	Hitachi S40/M40	5	100.0	0.0	0.0	59.0	4.0	e*

Transaminase GOT/AST

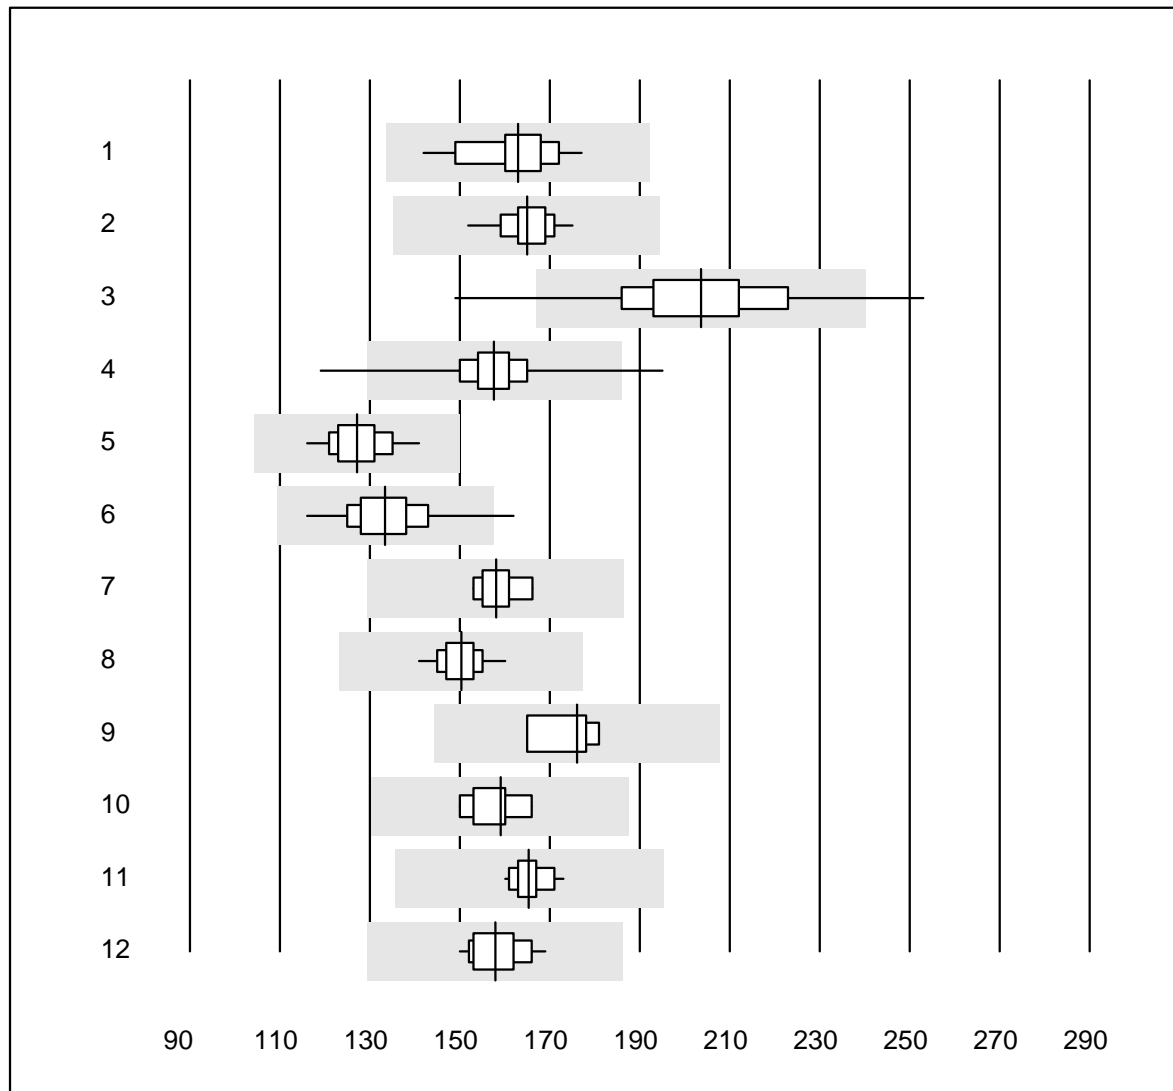


QUALAB Toleranz : 18 %

Transaminase GOT/AST (U/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC avec PP	34	100.0	0.0	0.0	163	4.9	e
2 Cobas	14	100.0	0.0	0.0	165	3.4	e
3 Reflotron	696	97.1	1.9	1.0	204	7.3	e
4 Fuji Dri-Chem	864	99.0	0.7	0.3	158	4.2	e
5 Spotchem/Ready	94	100.0	0.0	0.0	127	4.3	e
6 Spotchem D-Concept	283	98.9	1.1	0.0	133	5.6	e
7 IFCC sens PP	6	100.0	0.0	0.0	158	3.0	e
8 Piccolo	55	100.0	0.0	0.0	150	2.7	e
9 Skyla	4	100.0	0.0	0.0	176	4.0	e
10 Abx Mira	8	100.0	0.0	0.0	159	3.1	e
11 Hitachi S40/M40	17	94.1	0.0	5.9	165	2.2	e
12 Autolyser/DiaSys	17	100.0	0.0	0.0	158	3.4	e

Transaminase GPT/ALT

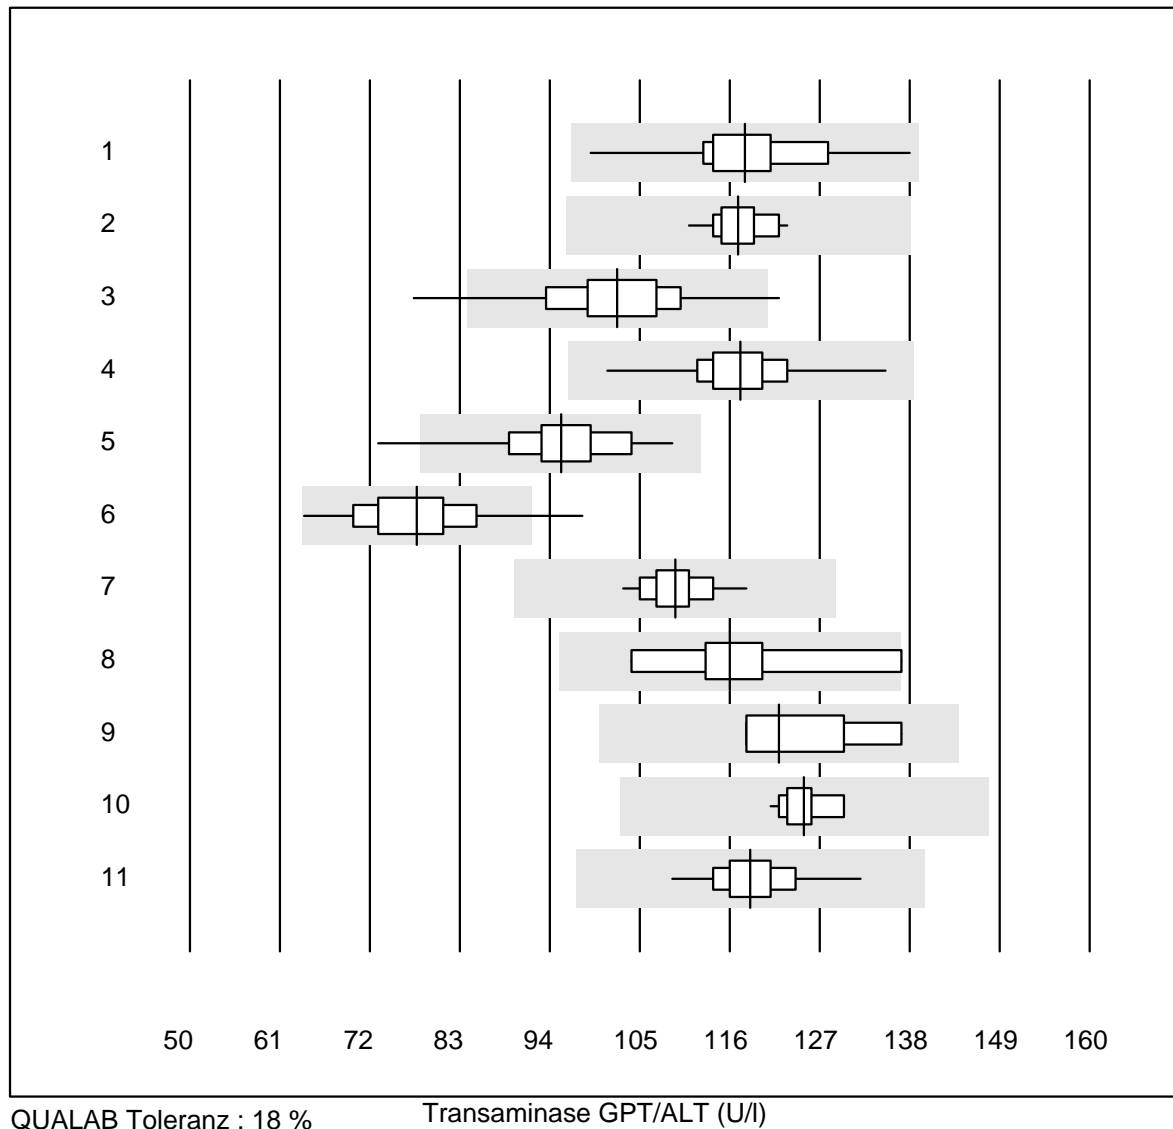


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC avec PP	31	100.0	0.0	0.0	118	6.5	e
2 Cobas	21	100.0	0.0	0.0	117	2.7	e
3 Reflotron	719	98.2	1.1	0.7	102	6.6	e
4 Fuji Dri-Chem	879	99.0	0.0	1.0	117	4.0	e
5 Spotchem/Ready	98	95.9	3.1	1.0	95	7.0	e
6 Spotchem D-Concept	286	98.3	1.4	0.3	78	7.3	e
7 Piccolo	56	100.0	0.0	0.0	109	3.1	e
8 Skyla	5	80.0	20.0	0.0	116	10.3	e*
9 Abx Mira	7	100.0	0.0	0.0	122	5.8	e*
10 Hitachi S40/M40	17	94.1	0.0	5.9	125	2.2	e
11 Autolyser/DiaSys	17	100.0	0.0	0.0	119	4.2	e

Triglycérides

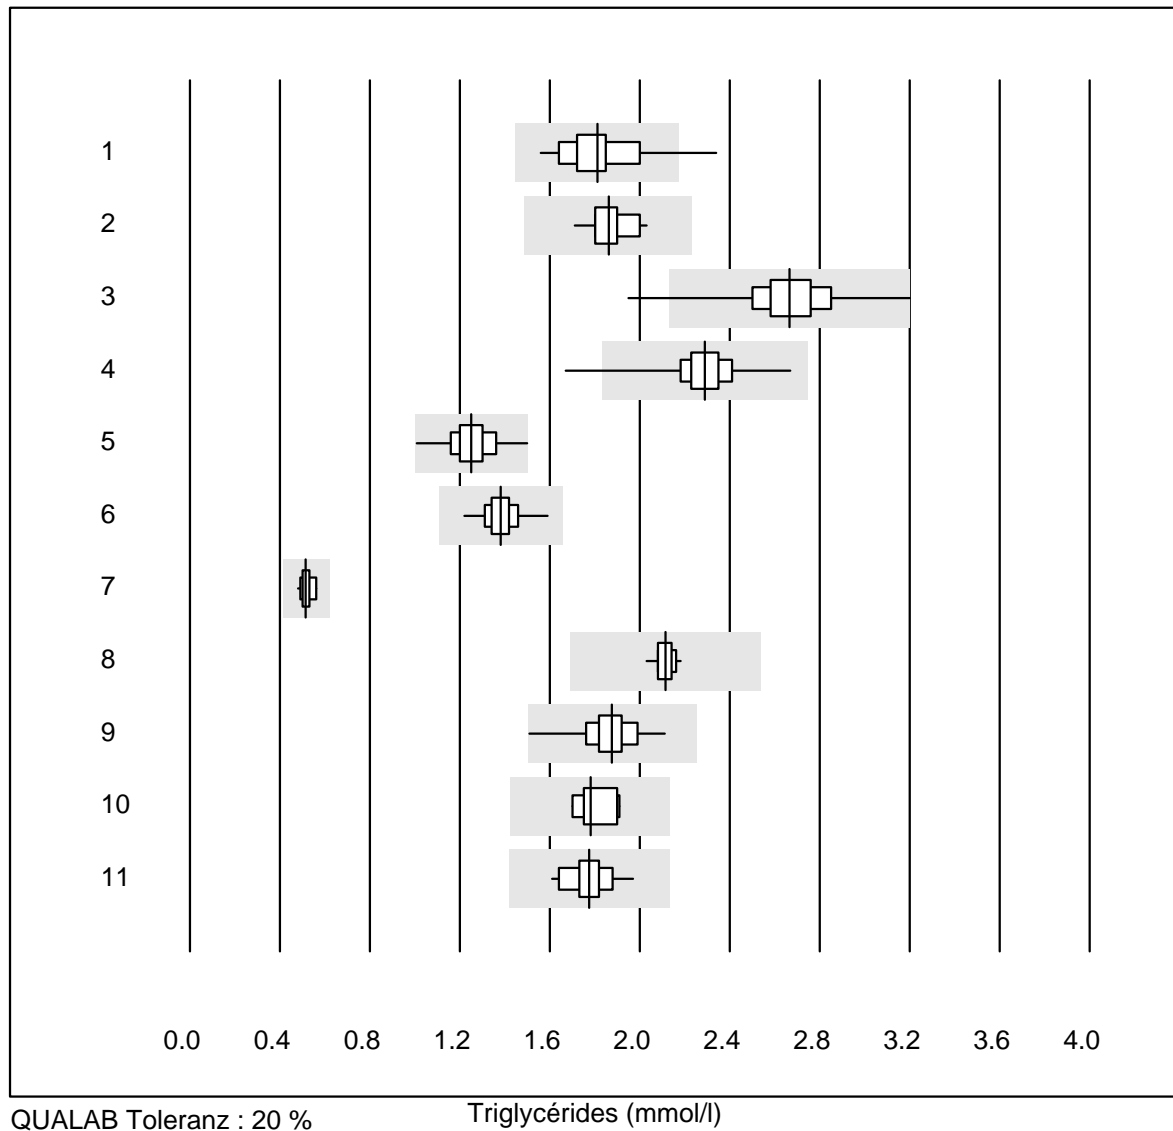


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	29	96.6	3.4	0.0	1.81	8.1	e
2	Cobas	21	100.0	0.0	0.0	1.86	4.6	e
3	Reflotron	420	98.3	0.5	1.2	2.67	5.8	e
4	Fuji Dri-Chem	766	99.1	0.5	0.4	2.29	4.4	e
5	Spotchem/Ready	79	97.5	0.0	2.5	1.25	6.7	e
6	Spotchem D-Concept	252	98.8	0.0	1.2	1.38	4.6	e
7	Hitachi S40/M40	13	100.0	0.0	0.0	0.52	5.0	e
8	Piccolo	22	100.0	0.0	0.0	2.11	1.7	e
9	Cholestech LDX	124	99.2	0.0	0.8	1.88	4.9	e
10	Abx Mira	7	100.0	0.0	0.0	1.78	4.3	e
11	Autolyser/DiaSys	17	100.0	0.0	0.0	1.77	5.4	e

Lithium

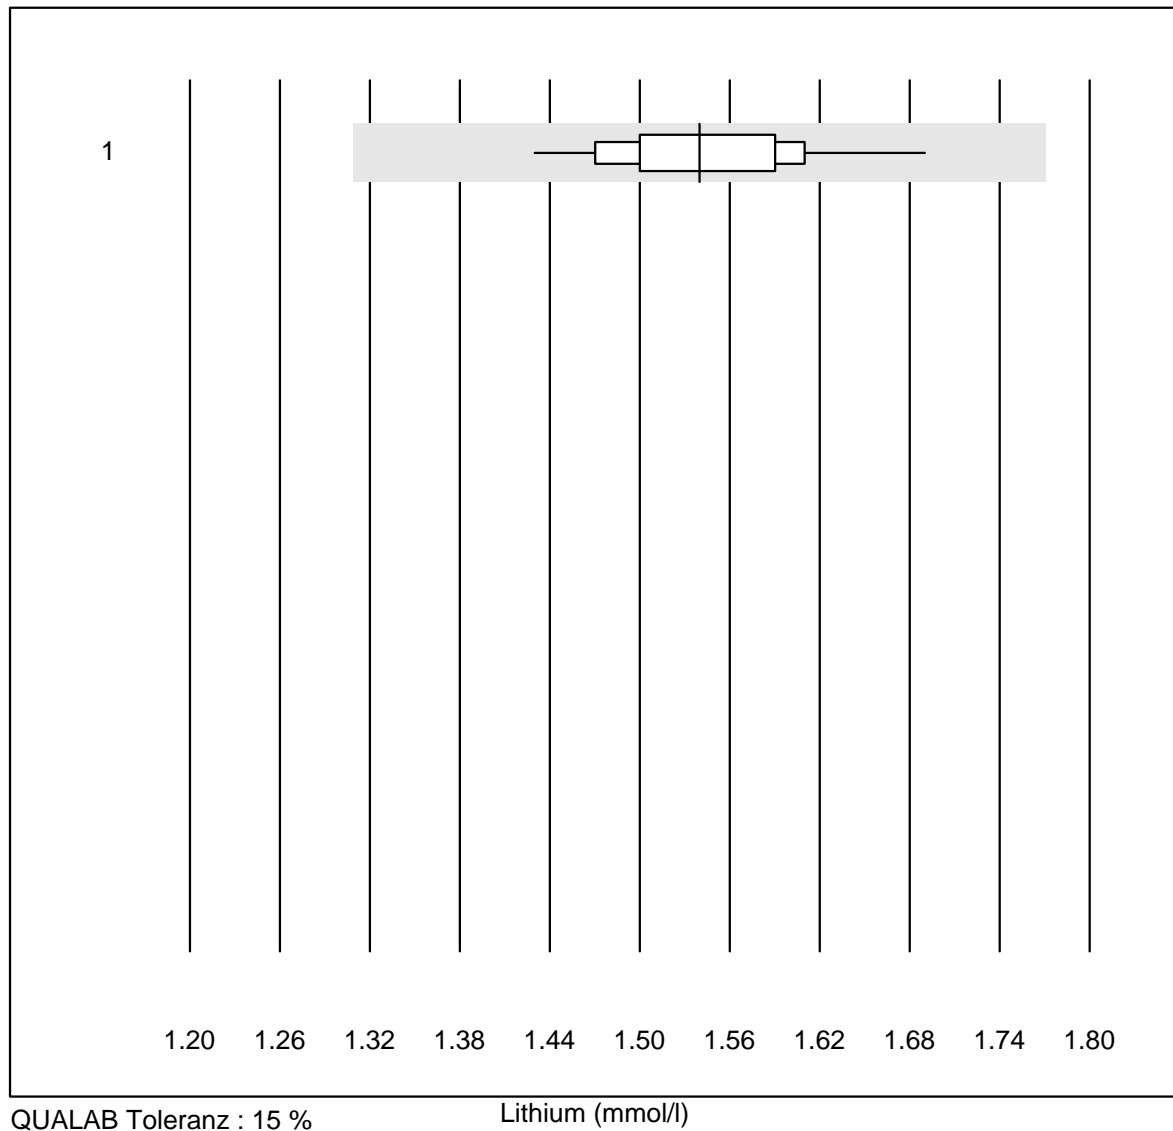


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	18	100.0	0.0	0.0	1.54	4.0	e

Laktat

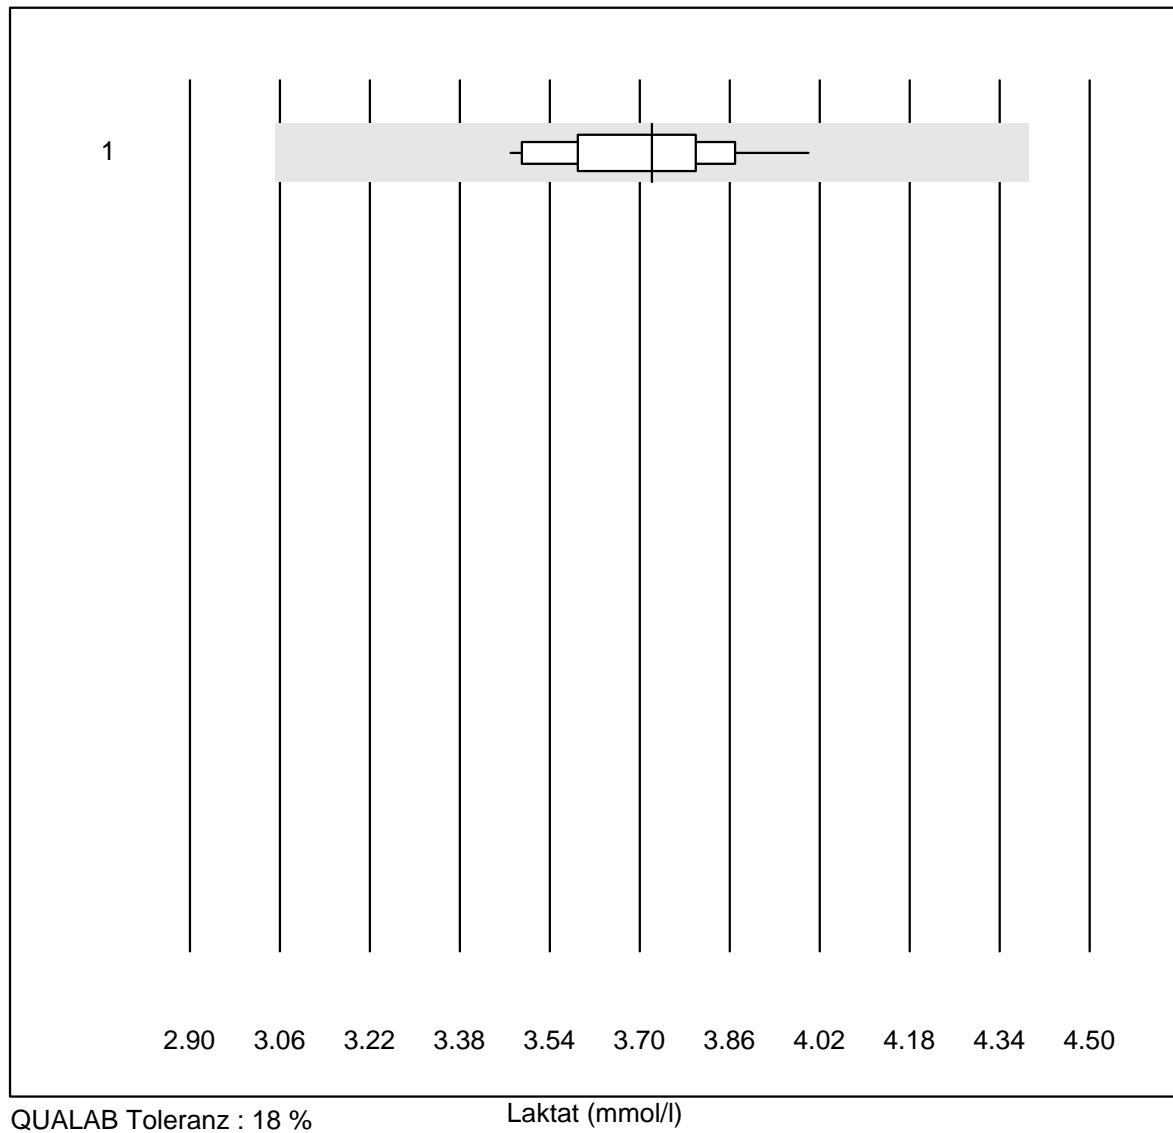

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	13	92.3	0.0	7.7	3.72	4.1	e

HbA1c échantillon A

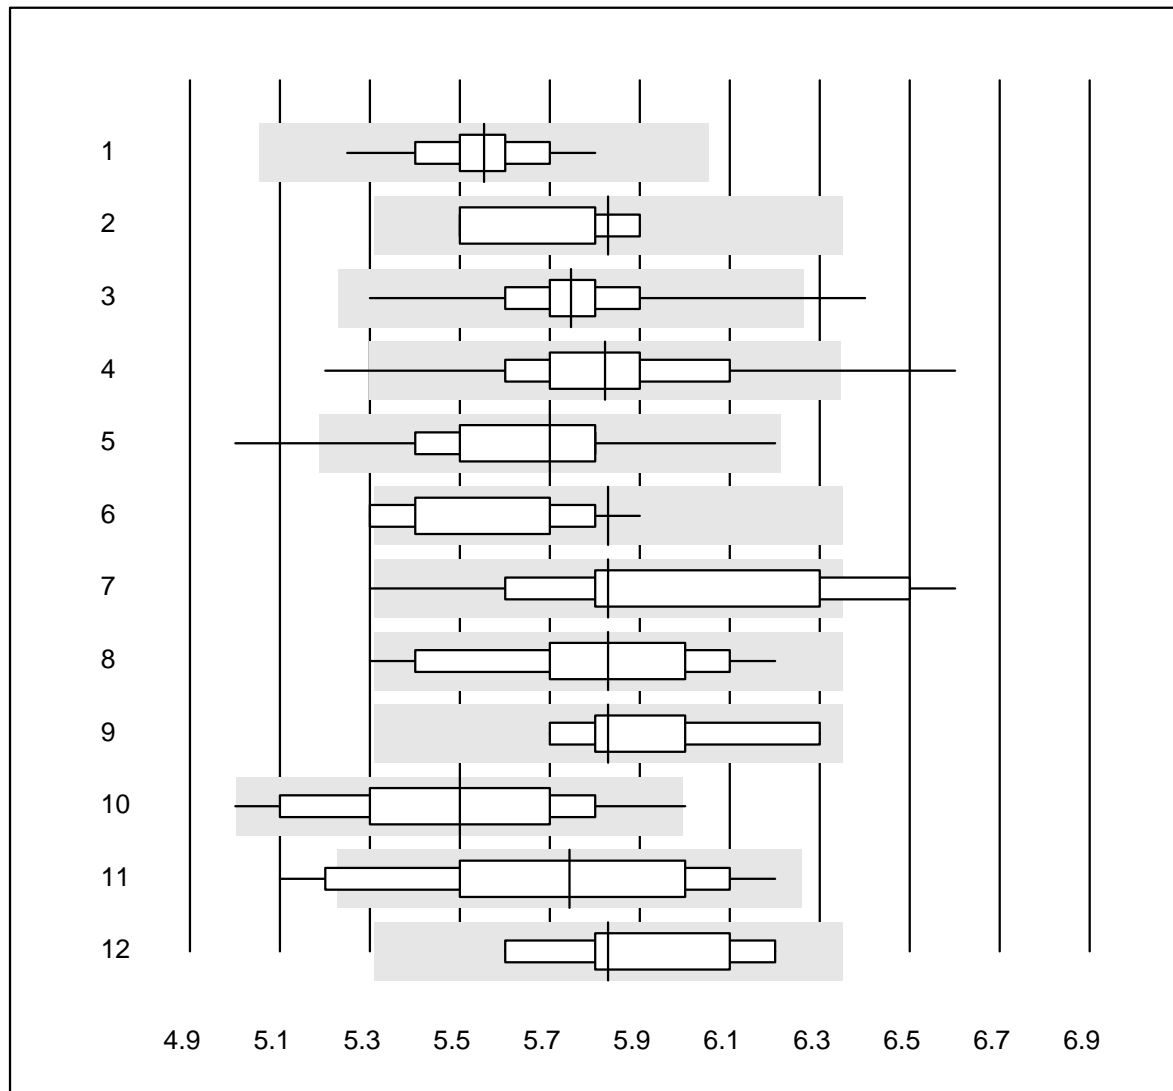


QUALAB Toleranz : 9 %

HbA1c échantillon A (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Roche, Cobas	13	100.0	0.0	0.0	5.6	2.5	e
2	HPLC	7	100.0	0.0	0.0	5.8	2.7	a
3	Afinion	777	99.6	0.1	0.3	5.7	2.4	e
4	Cobas b101	105	97.1	1.9	1.0	5.8	3.4	e
5	DCA2000/Vantage	236	99.2	0.4	0.4	5.7	3.1	e
6	Celltac chemi	11	72.7	18.2	9.1	5.8	3.6	a
7	NycoCard	48	66.7	22.9	10.4	5.8	5.2	a
8	Eurolyser	18	94.4	5.6	0.0	5.8	4.2	a
9	Hemocue HbA1c 501	9	77.8	0.0	22.2	5.8	3.3	a
10	AFIAS	50	90.0	8.0	2.0	5.5	4.5	a
11	Andere	14	78.6	21.4	0.0	5.7	6.4	e*
12	Spinit	8	87.5	0.0	12.5	5.8	3.5	a


HbA1c échantillon B

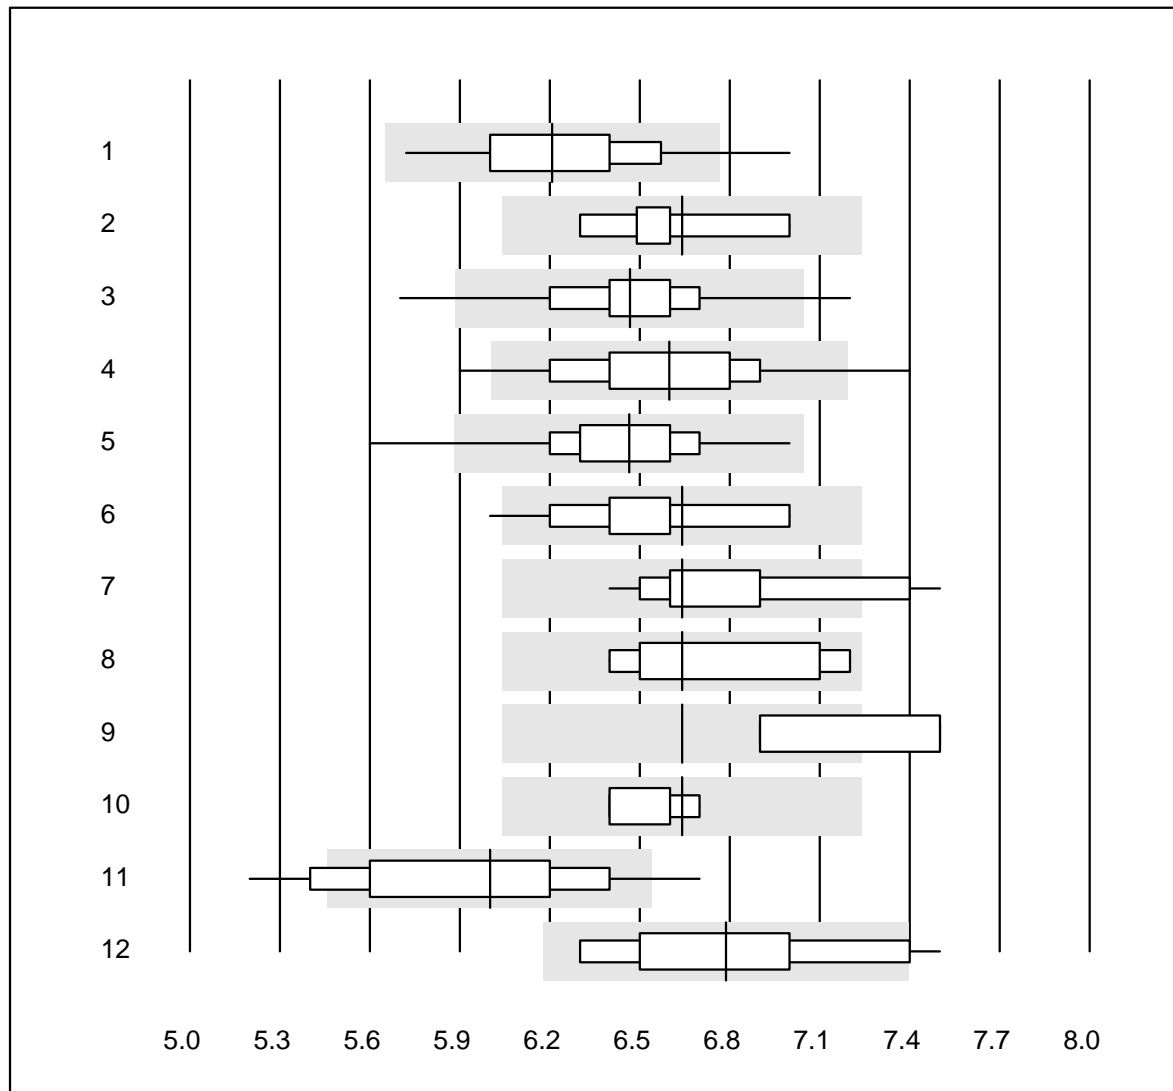

QUALAB Toleranz : 9 %


HbA1c échantillon B (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Roche, Cobas	15	93.3	6.7	0.0	6.2	4.9	e*
2	HPLC	9	100.0	0.0	0.0	6.6	3.2	a
3	Afinion	568	98.6	1.2	0.2	6.5	2.9	e
4	Cobas b101	67	97.0	3.0	0.0	6.6	3.9	e
5	DCA2000/Vantage	160	98.1	1.3	0.6	6.5	3.5	e
6	Celltac chemi	12	91.7	8.3	0.0	6.6	4.5	a
7	NycoCard	24	87.5	12.5	0.0	6.6	4.4	a
8	Eurolyser	8	100.0	0.0	0.0	6.6	4.5	a
9	Hemocue HbA1c 501	5	20.0	20.0	60.0	6.6	5.9	a
10	A1c Now	4	100.0	0.0	0.0	6.6	2.3	a
11	AFIAS	49	83.7	14.3	2.0	6.0	6.3	a
12	Andere	16	87.5	12.5	0.0	6.8	5.4	e*

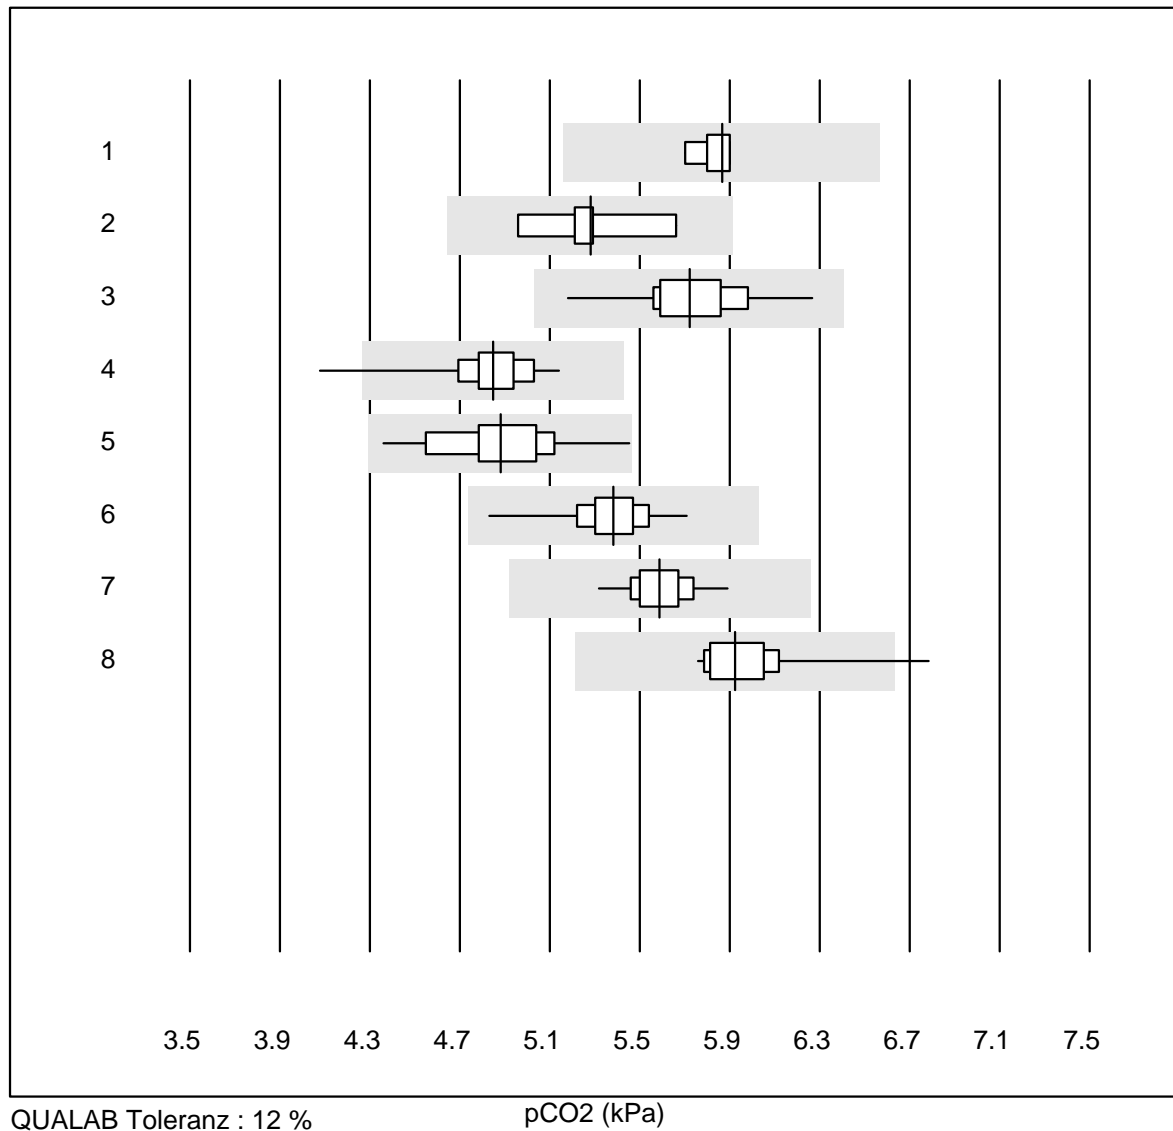pCO₂


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	GEM	5	100.0	0.0	0.0	5.87	1.5	e
2	ABL80 FLEX	8	100.0	0.0	0.0	5.28	3.7	e
3	Cobas b123	22	100.0	0.0	0.0	5.72	4.0	e
4	iStat	45	95.6	4.4	0.0	4.85	4.0	e
5	EPOC	42	90.5	0.0	9.5	4.88	4.5	e
6	ABL700/800	81	100.0	0.0	0.0	5.38	3.0	e
7	ABL90 FLEX / PLUS	57	100.0	0.0	0.0	5.59	2.1	e
8	ABL80 FLEX CO-OX / O	15	86.6	6.7	6.7	5.92	4.3	e

pO2

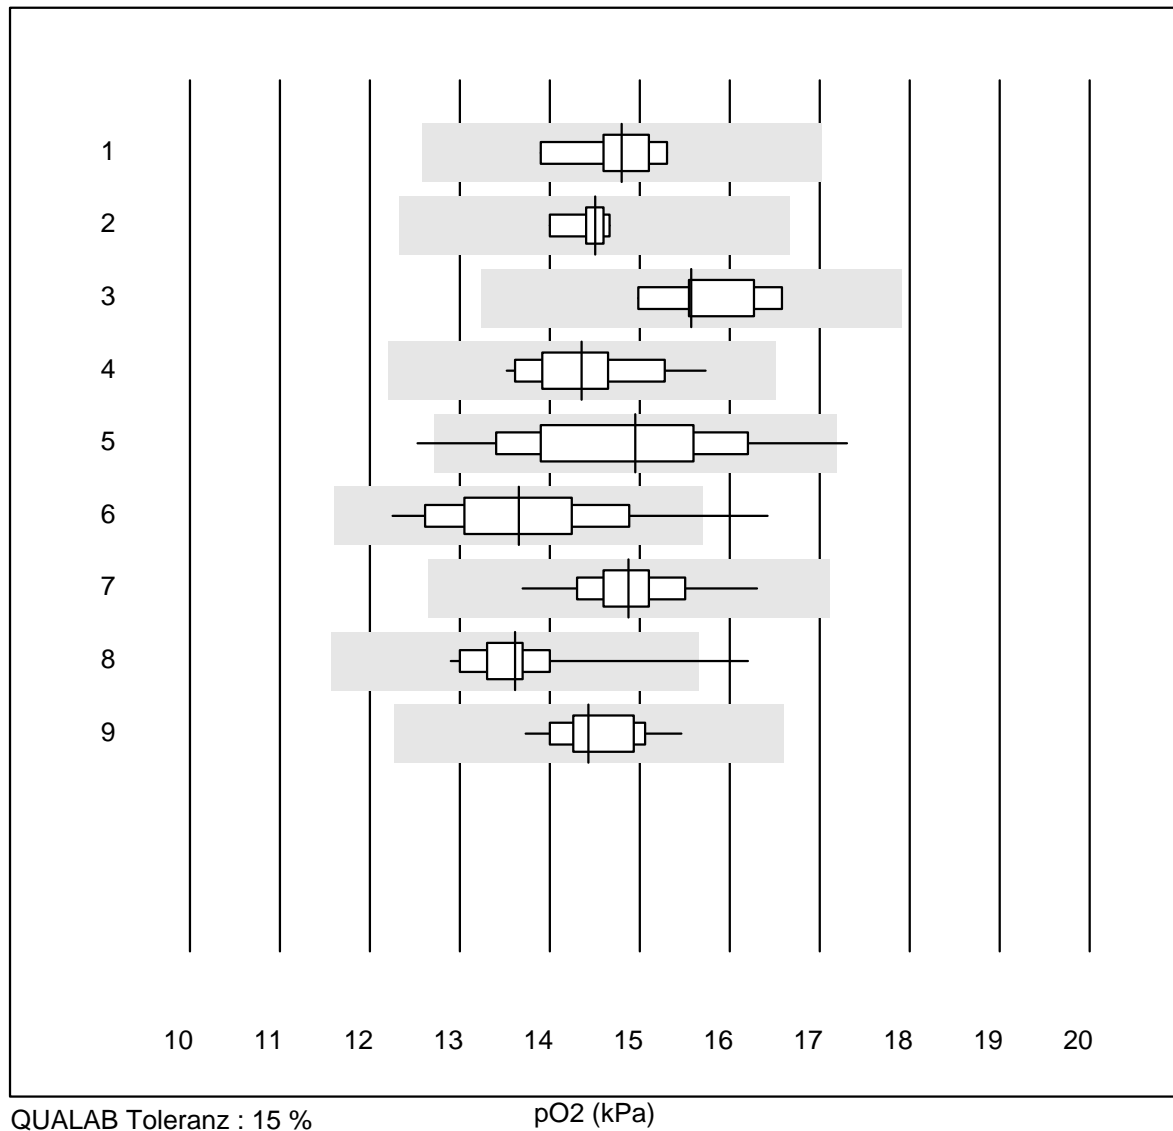


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	GEM	5	100.0	0.0	0.0	14.80	3.7	e
2	ABL80 FLEX	7	100.0	0.0	0.0	14.50	1.5	e
3	Cobas b221	5	100.0	0.0	0.0	15.57	4.0	e
4	Cobas b123	14	92.9	0.0	7.1	14.35	4.6	e
5	iStat	44	95.5	4.5	0.0	14.95	7.4	e
6	EPOC	42	90.5	2.4	7.1	13.66	6.6	e
7	ABL700/800	78	97.4	0.0	2.6	14.88	3.2	e
8	ABL90 FLEX / PLUS	58	93.2	3.4	3.4	13.61	4.7	e
9	ABL80 FLEX CO-OX / O	15	93.3	0.0	6.7	14.43	3.3	e

pH

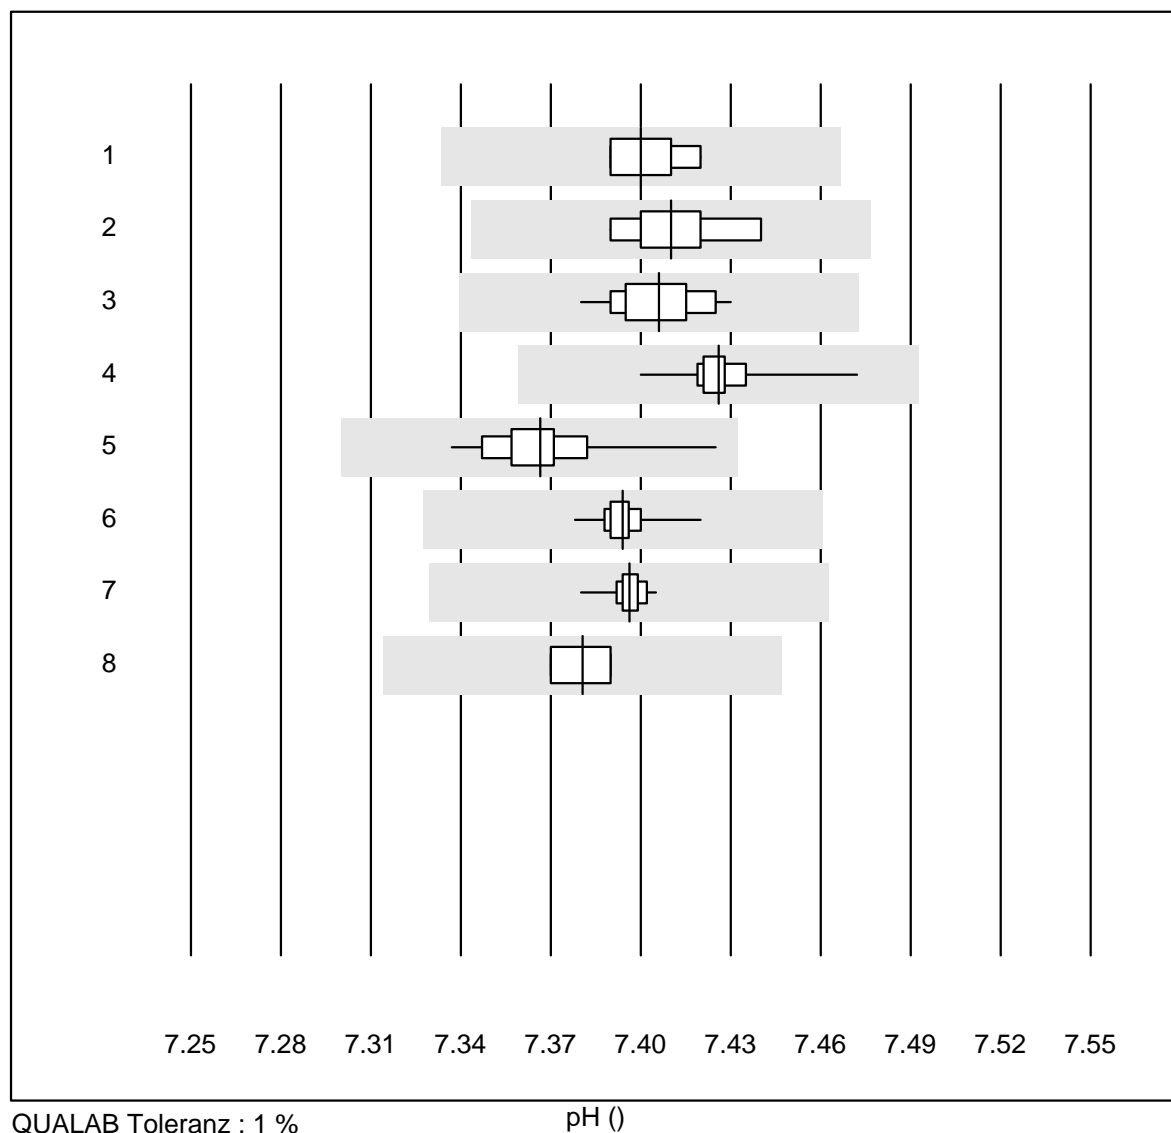


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 GEM	5	100.0	0.0	0.0	7.40	0.2	e
2 ABL80 FLEX	8	100.0	0.0	0.0	7.41	0.2	e
3 Cobas b123	22	100.0	0.0	0.0	7.41	0.2	e
4 iStat	45	100.0	0.0	0.0	7.43	0.1	e
5 EPOC	41	97.6	0.0	2.4	7.37	0.2	e
6 ABL700/800	81	100.0	0.0	0.0	7.39	0.1	e
7 ABL90 FLEX / PLUS	58	100.0	0.0	0.0	7.40	0.1	e
8 ABL80 FLEX CO-OX / O	15	100.0	0.0	0.0	7.38	0.1	e

Glucose GS

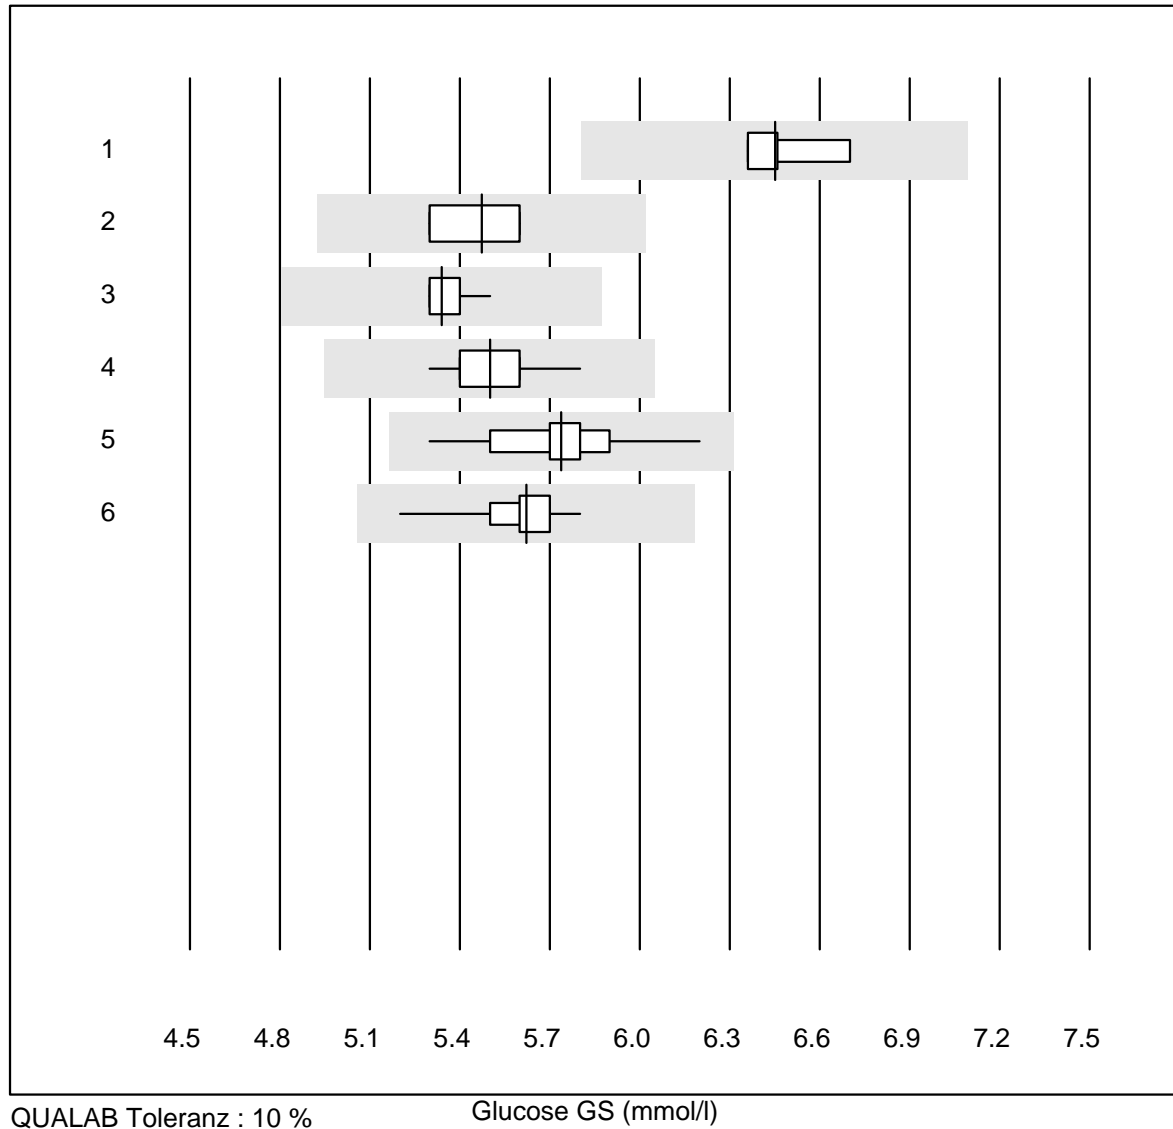

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas b221	4	100.0	0.0	0.0	6.5	2.3	e
2	Cobas b123	11	100.0	0.0	0.0	5.5	2.3	e
3	iStat	10	100.0	0.0	0.0	5.3	1.3	e
4	EPOC	30	96.7	0.0	3.3	5.5	1.9	e
5	ABL700/800	70	100.0	0.0	0.0	5.7	2.6	e
6	ABL90 FLEX / PLUS	57	100.0	0.0	0.0	5.6	1.9	e

Hémoglobine BG

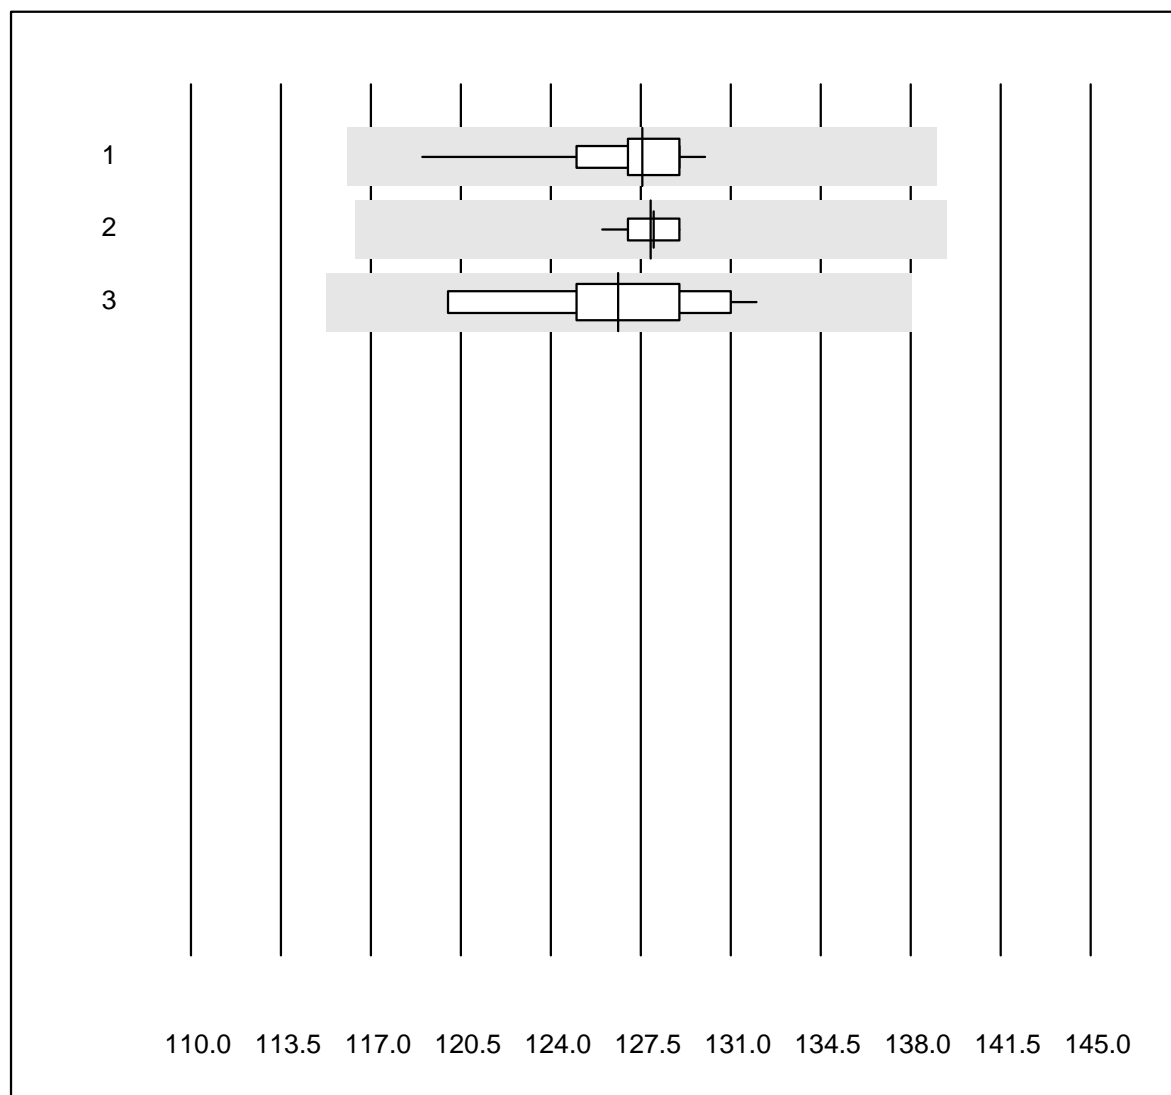


QUALAB Toleranz : 9 %

Hémoglobine BG (g/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL700/800	70	92.9	0.0	7.1	127.6	1.9	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	57	100.0	0.0	0.0	127.9	0.5	e
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	14	100.0	0.0	0.0	126.6	2.8	e

Potassium BG

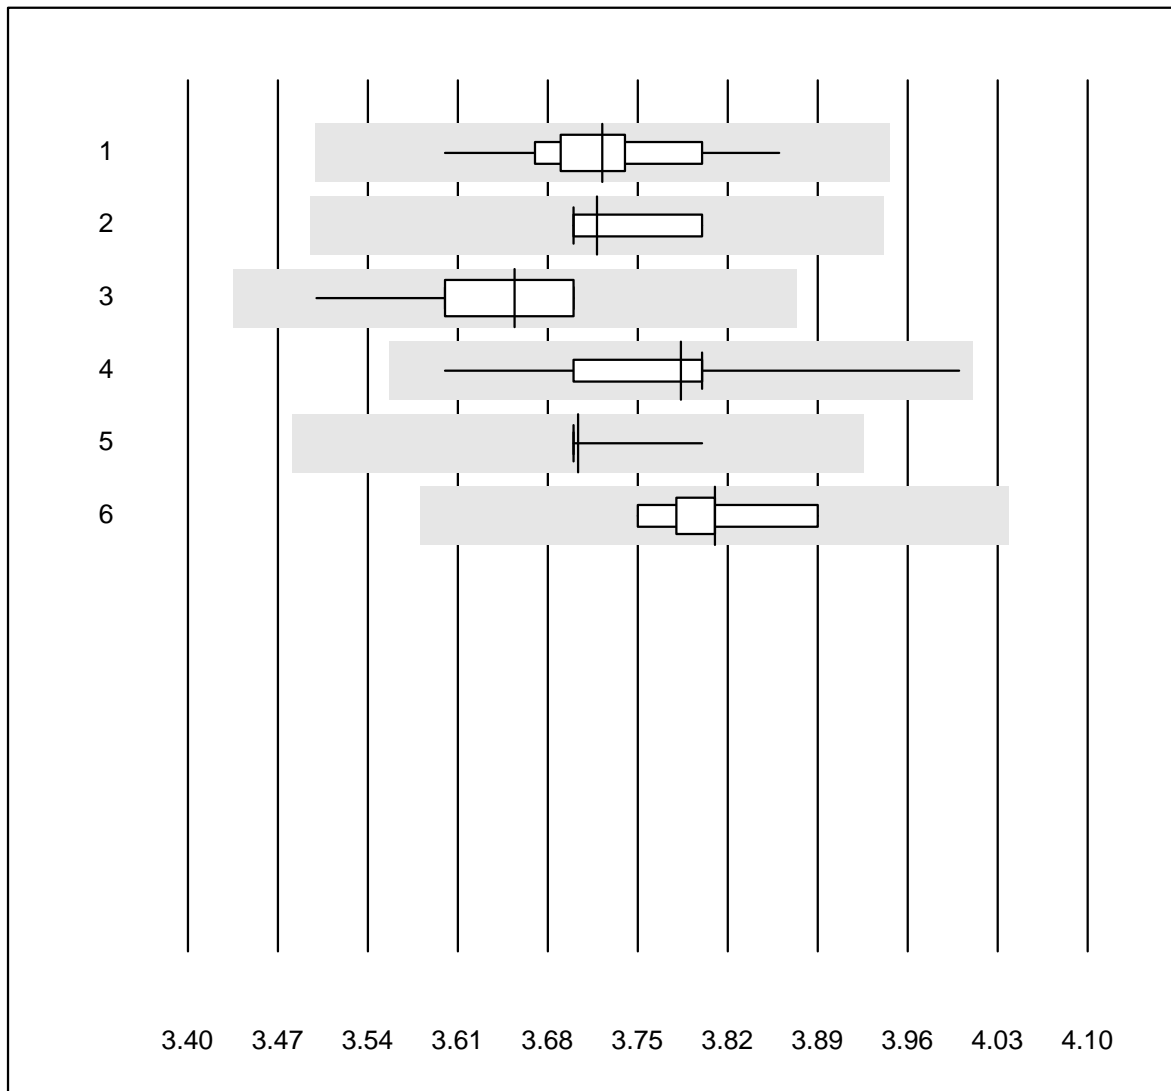


QUALAB Toleranz : 6 %

Potassium BG (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas b123	23	100.0	0.0	0.0	3.7	1.5	e
2	iStat	19	100.0	0.0	0.0	3.7	1.0	e
3	EPOC	36	97.2	0.0	2.8	3.7	1.5	e
4	ABL700/800	72	100.0	0.0	0.0	3.8	1.5	e
5	ABL90 FLEX / PLUS	58	100.0	0.0	0.0	3.7	0.5	e
6	ABL80 FLEX CO-OX / O	6	100.0	0.0	0.0	3.8	1.2	e

Sodium BG

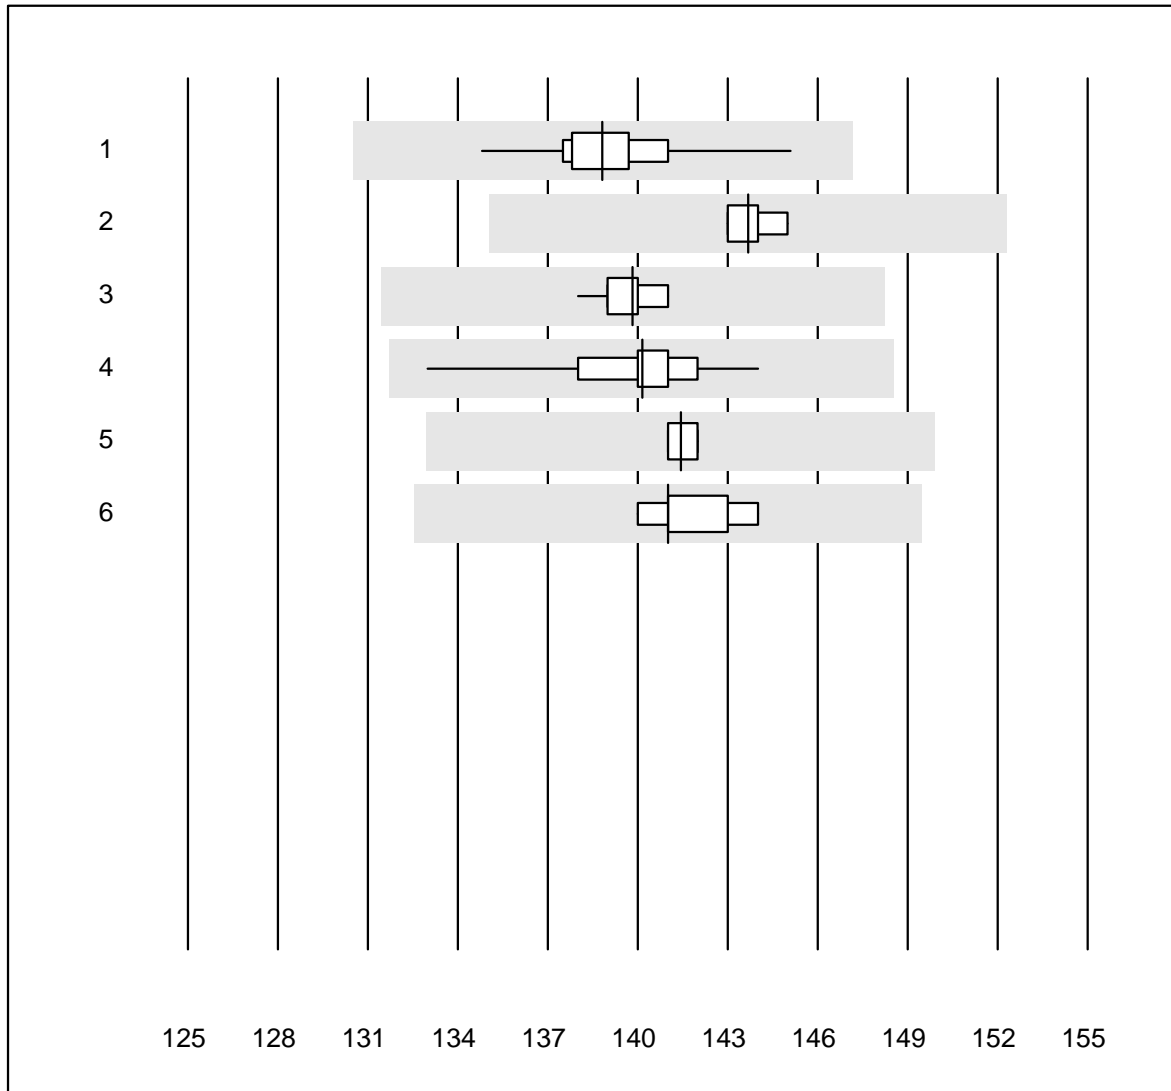


QUALAB Toleranz : 6 %

Sodium BG (mmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas b123	23	100.0	0.0	0.0	138.8	1.4	e
2	iStat	19	100.0	0.0	0.0	143.7	0.5	e
3	EPOC	33	100.0	0.0	0.0	139.8	0.5	e
4	ABL700/800	70	100.0	0.0	0.0	140.1	1.1	e
5	ABL90 FLEX / PLUS	58	100.0	0.0	0.0	141.4	0.4	e
6	ABL80 FLEX CO-OX / O	6	100.0	0.0	0.0	141.0	1.1	e

Chlorure-BG

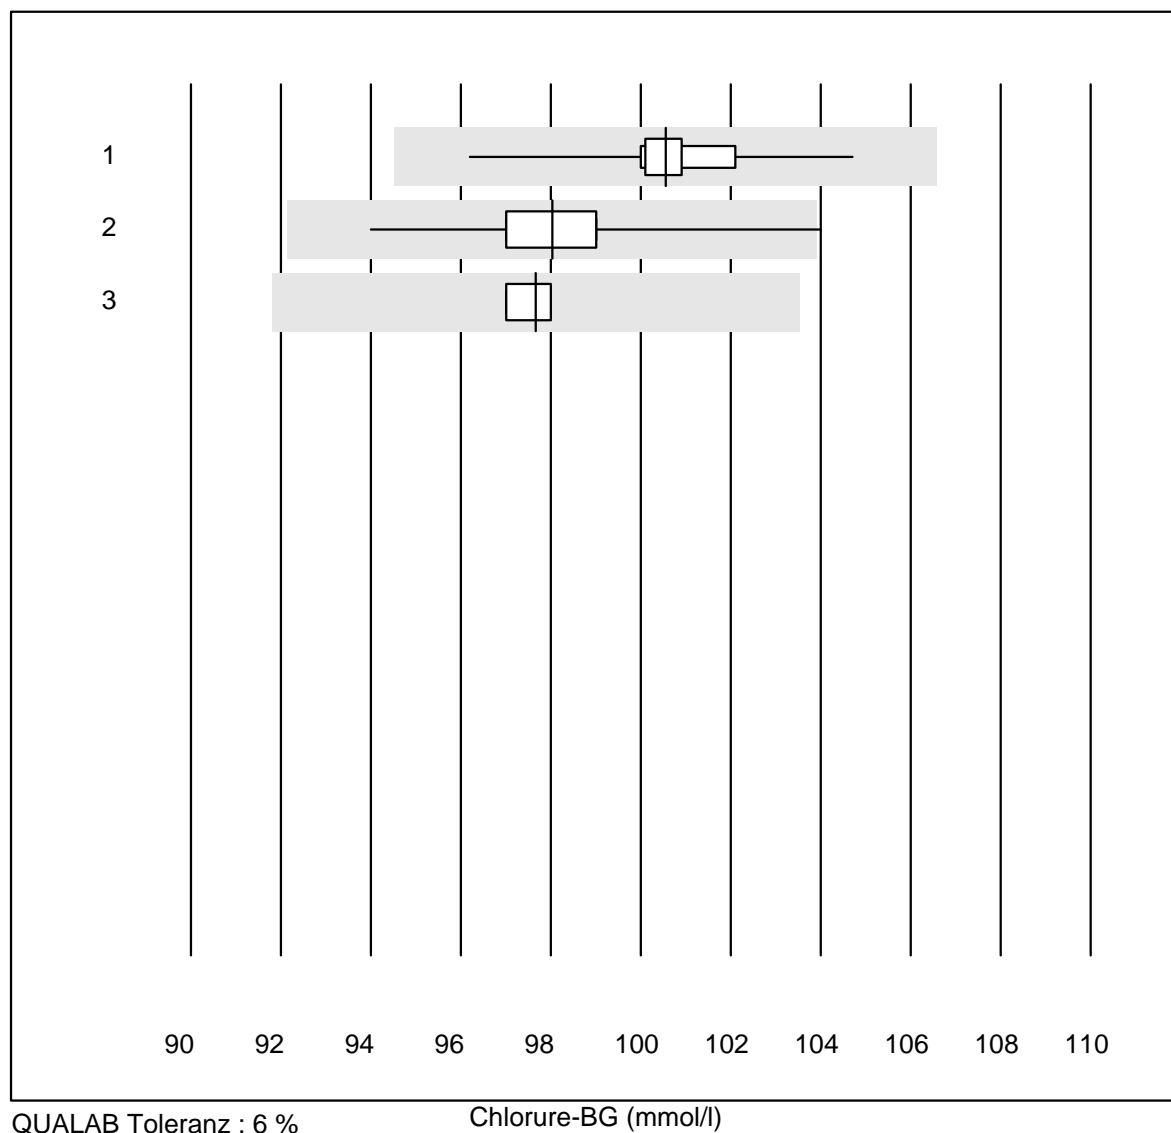

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas b123	12	100.0	0.0	0.0	100.6	1.9	e
2	ABL700/800	62	98.4	1.6	0.0	98.0	1.6	e
3	ABL90 FLEX / PLUS	57	100.0	0.0	0.0	97.7	0.5	e

Calcium-BG

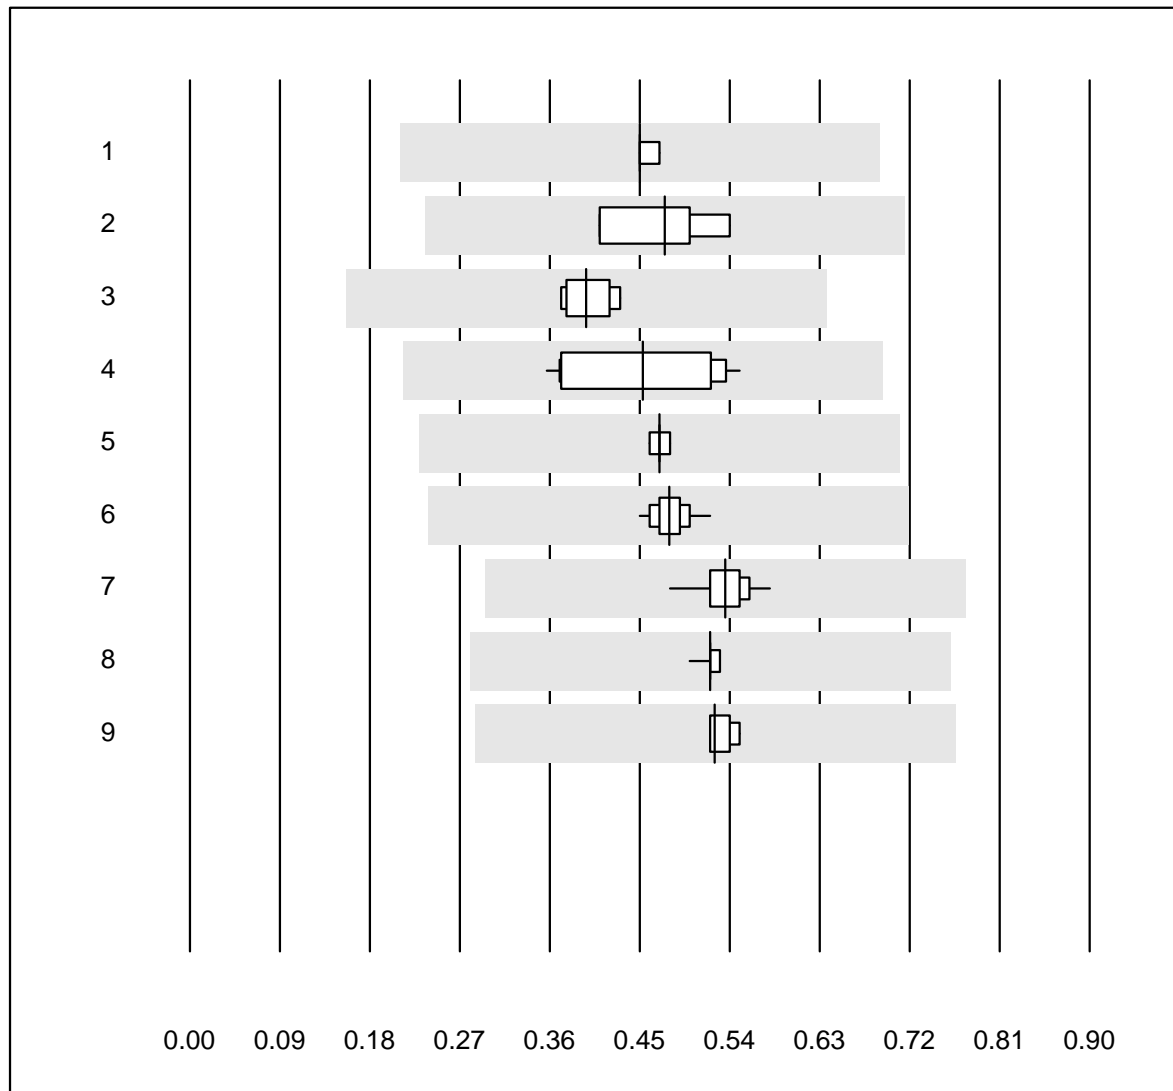


Tolérance MQ : 12 %
(< 2.00: +/- 0.24 mmol/l)

Calcium-BG (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 GEM	4	100.0	0.0	0.0	0.45	2.2	e
2 ABL80 FLEX	4	100.0	0.0	0.0	0.48	12.0	e*
3 Cobas b123	8	87.5	0.0	12.5	0.40	5.5	e*
4 Cobas	12	91.7	0.0	8.3	0.45	15.0	e*
5 iStat	10	100.0	0.0	0.0	0.47	1.4	e
6 EPOC	32	93.7	0.0	6.3	0.48	3.3	e
7 ABL700/800	68	100.0	0.0	0.0	0.54	3.1	e
8 ABL90 FLEX / PLUS	58	100.0	0.0	0.0	0.52	0.9	e
9 ABL80 FLEX CO-OX / O	5	100.0	0.0	0.0	0.53	2.5	e

FHHb

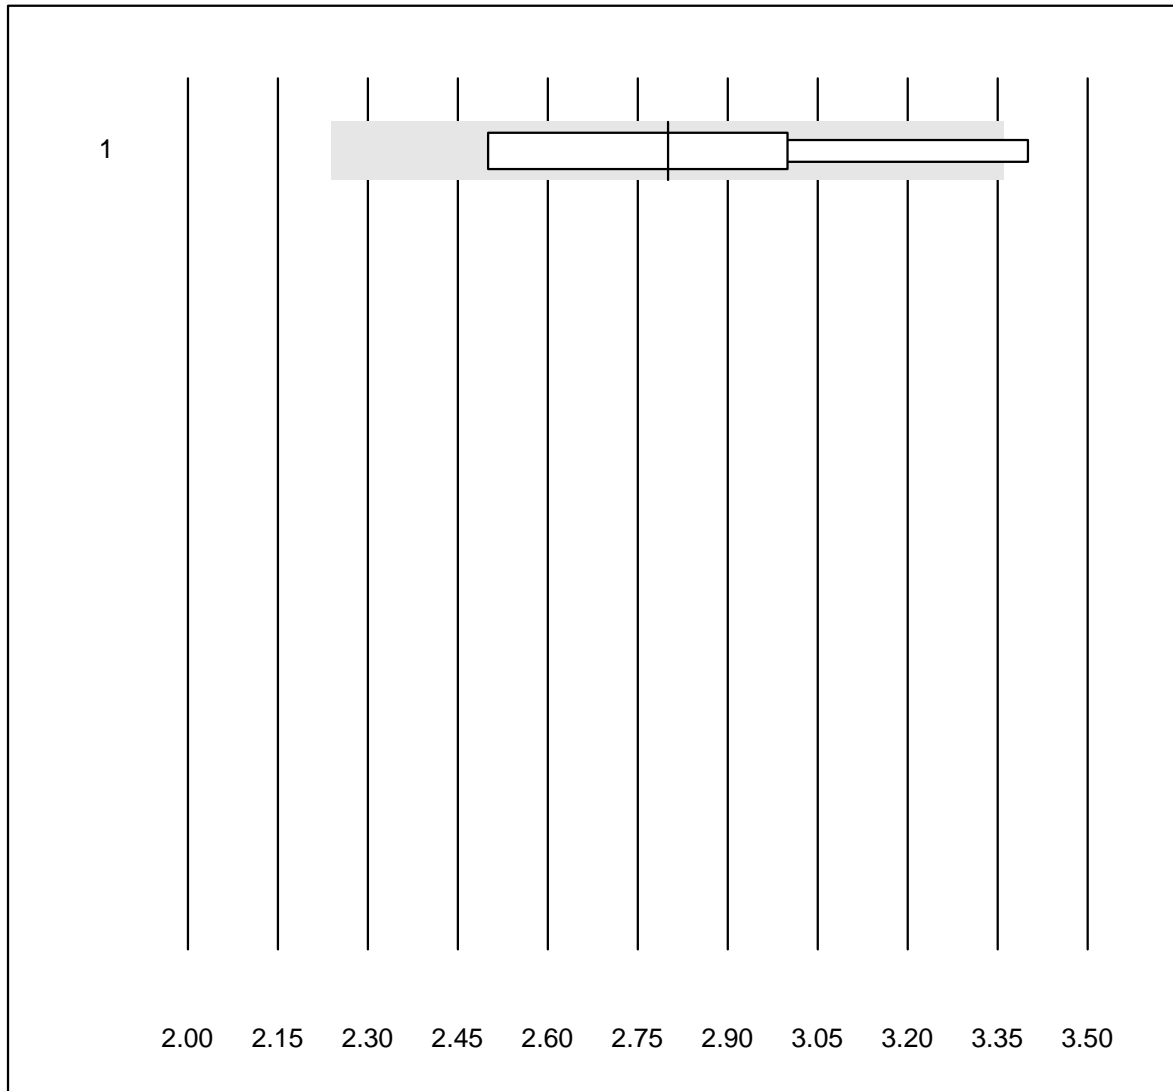


Tolérance MQ : 20 %

FHHb (%)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL80 FLEX CO-OX / O	7	85.7	14.3	0.0	2.800	12.0	e*

Lactate-BG

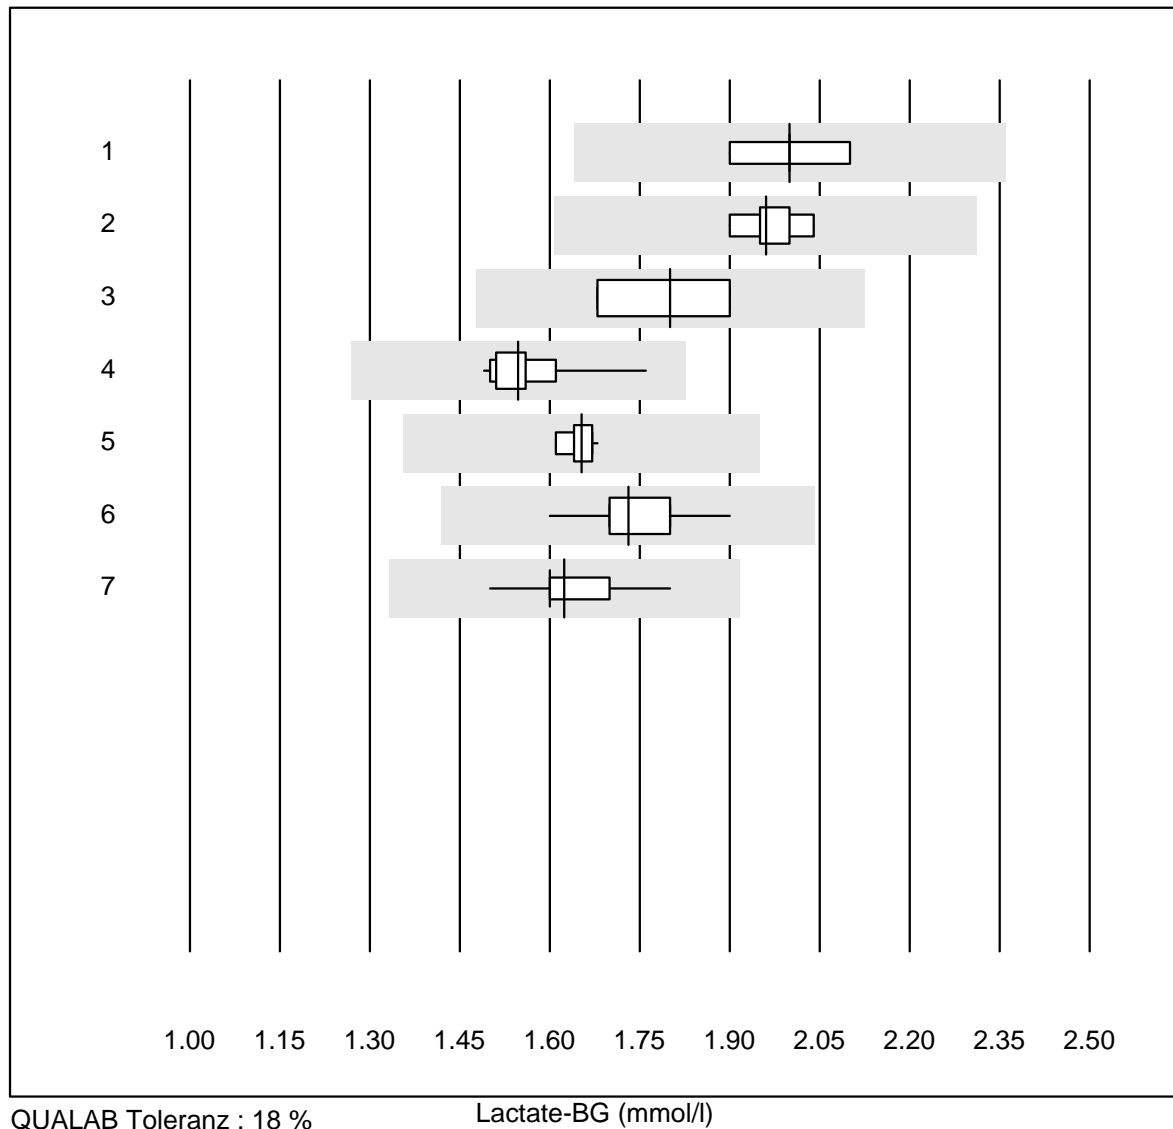

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas b123	9	100.0	0.0	0.0	2.00	3.0	e
2 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	1.96	2.7	e
3 IL	4	100.0	0.0	0.0	1.80	6.8	e*
4 EPOC	36	97.2	0.0	2.8	1.55	3.3	e
5 iStat	11	90.9	0.0	9.1	1.65	1.3	e
6 ABL700/800	74	100.0	0.0	0.0	1.73	3.6	e
7 ABL90 FLEX / PLUS	58	100.0	0.0	0.0	1.62	3.5	e

sO2 OR

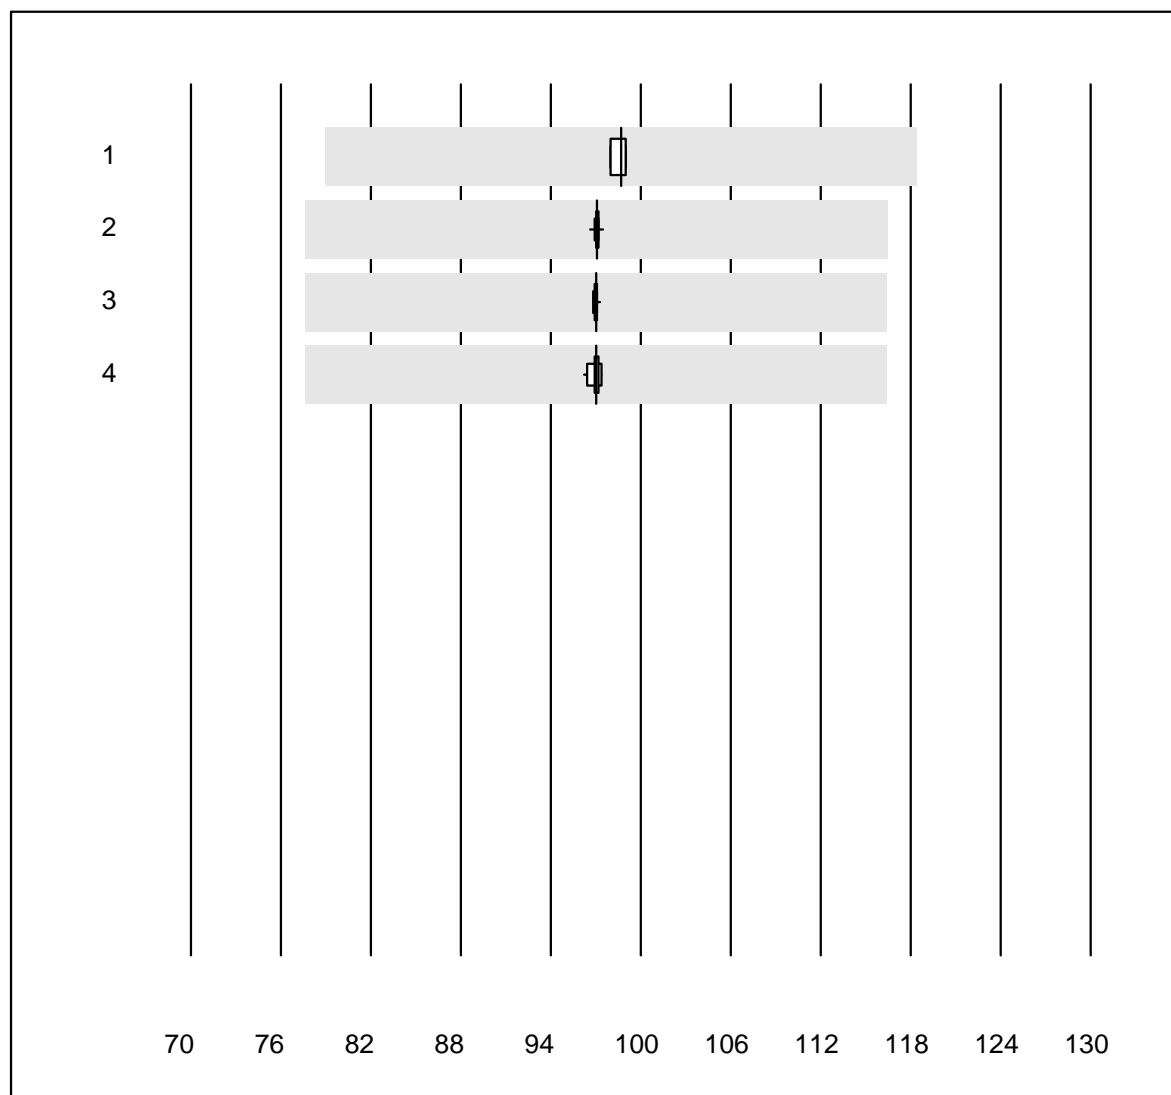


Tolérance MQ : 20 %

sO2 OR (%)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 iStat	12	100.0	0.0	0.0	98.667	0.5	e
2 ABL700/800	51	100.0	0.0	0.0	97.077	0.2	e
3 ABL90 FLEX / PLUS	50	100.0	0.0	0.0	97.002	0.1	e
4 ABL80 FLEX CO-OX / O	12	100.0	0.0	0.0	97.009	0.4	e

FO2Hb OR

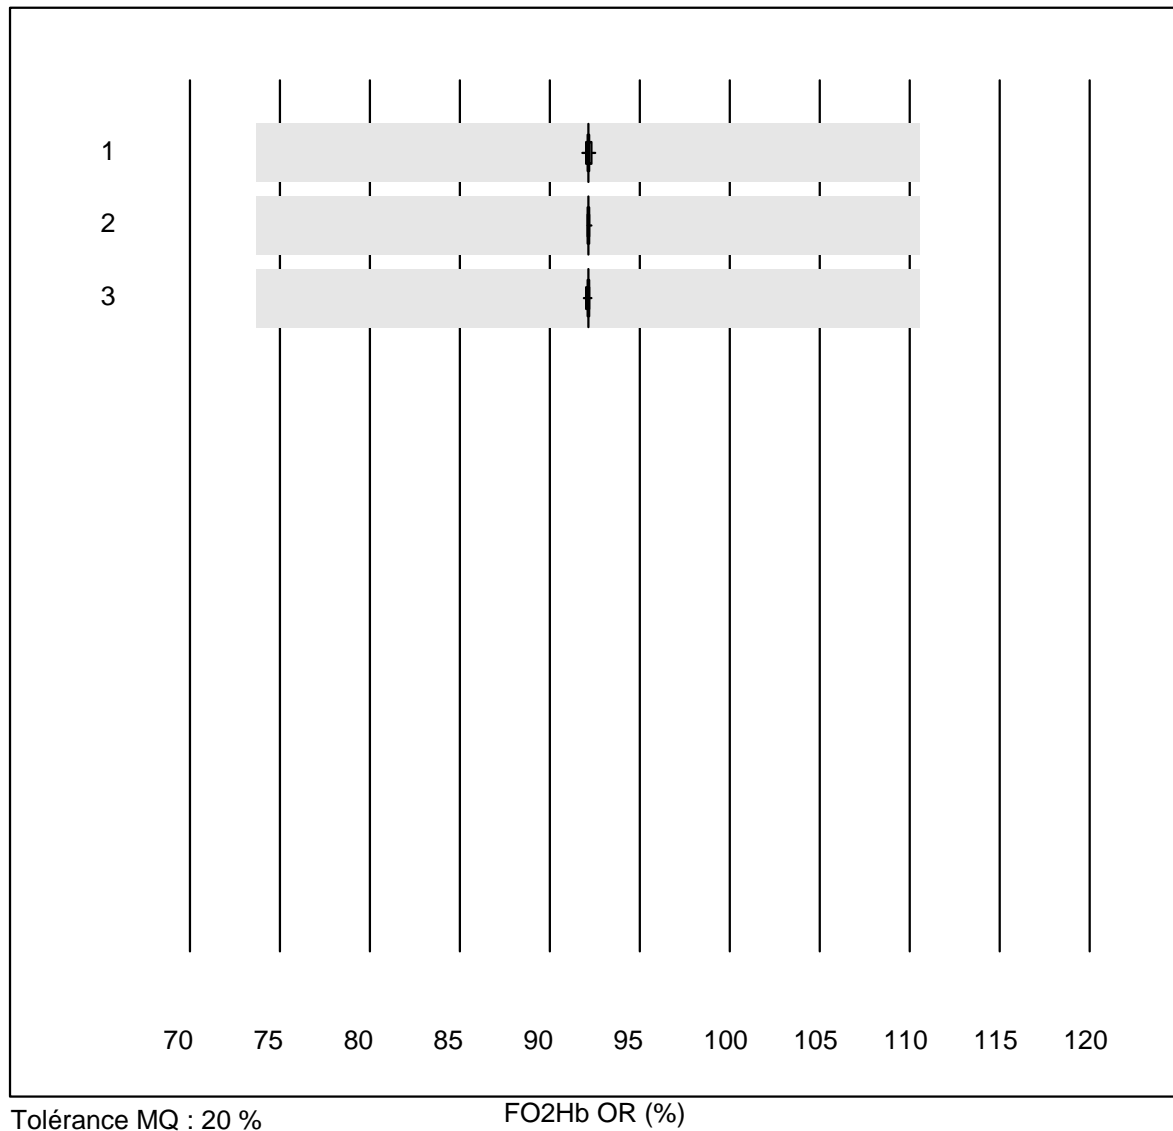


Tolérance MQ : 20 %

FO2Hb OR (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL700/800	51	100.0	0.0	0.0	92.128	0.1	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	51	100.0	0.0	0.0	92.147	0.1	e
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	14	100.0	0.0	0.0	92.131	0.1	e

FCOHb OR

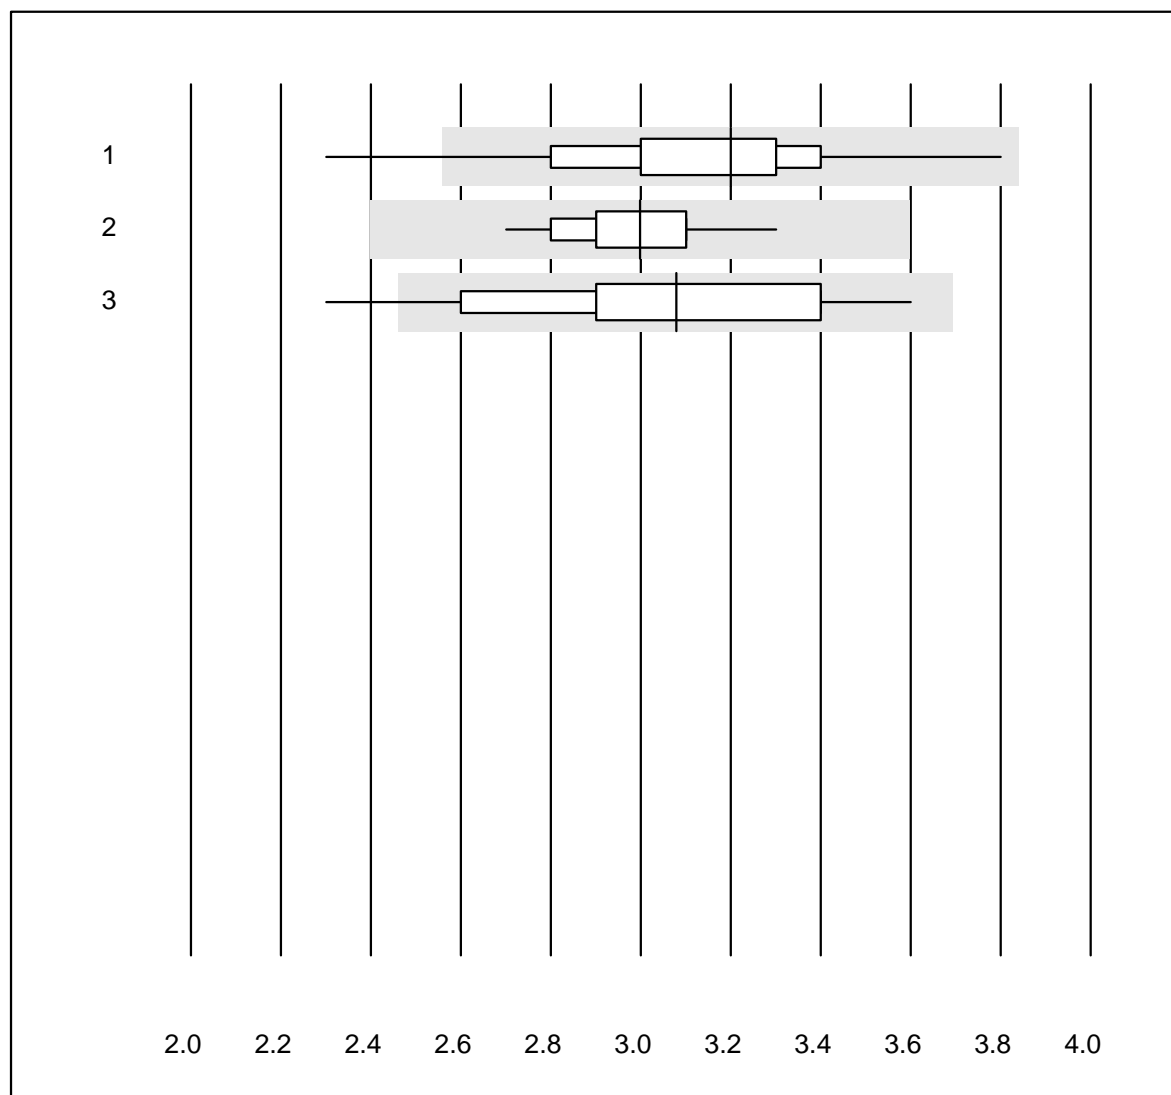


Tolérance MQ : 20 %

FCOHb OR (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL700/800	52	96.2	1.9	1.9	3.200	8.3	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	50	100.0	0.0	0.0	2.998	4.4	e
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	15	93.3	6.7	0.0	3.079	11.1	e*

FMetHb OR

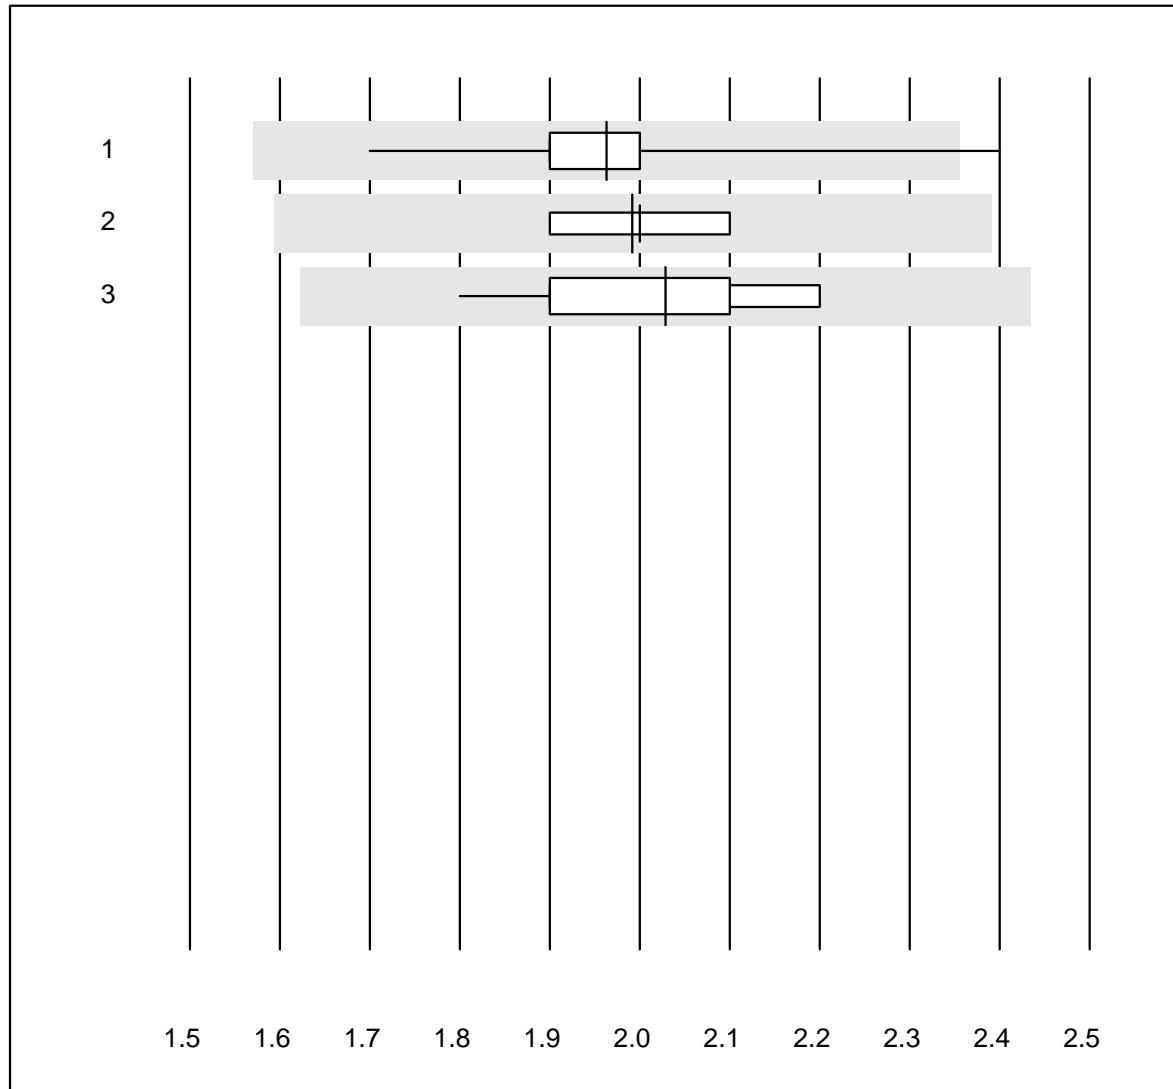


Tolérance MQ : 20 %

FMetHb OR (%)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 ABL700/800	55	94.6	3.6	1.8	1.963	6.2	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	50	100.0	0.0	0.0	1.992	2.8	e
3 ABL80 FLEX CO-OX / O	15	93.3	0.0	6.7	2.029	6.2	e

FHbF OR

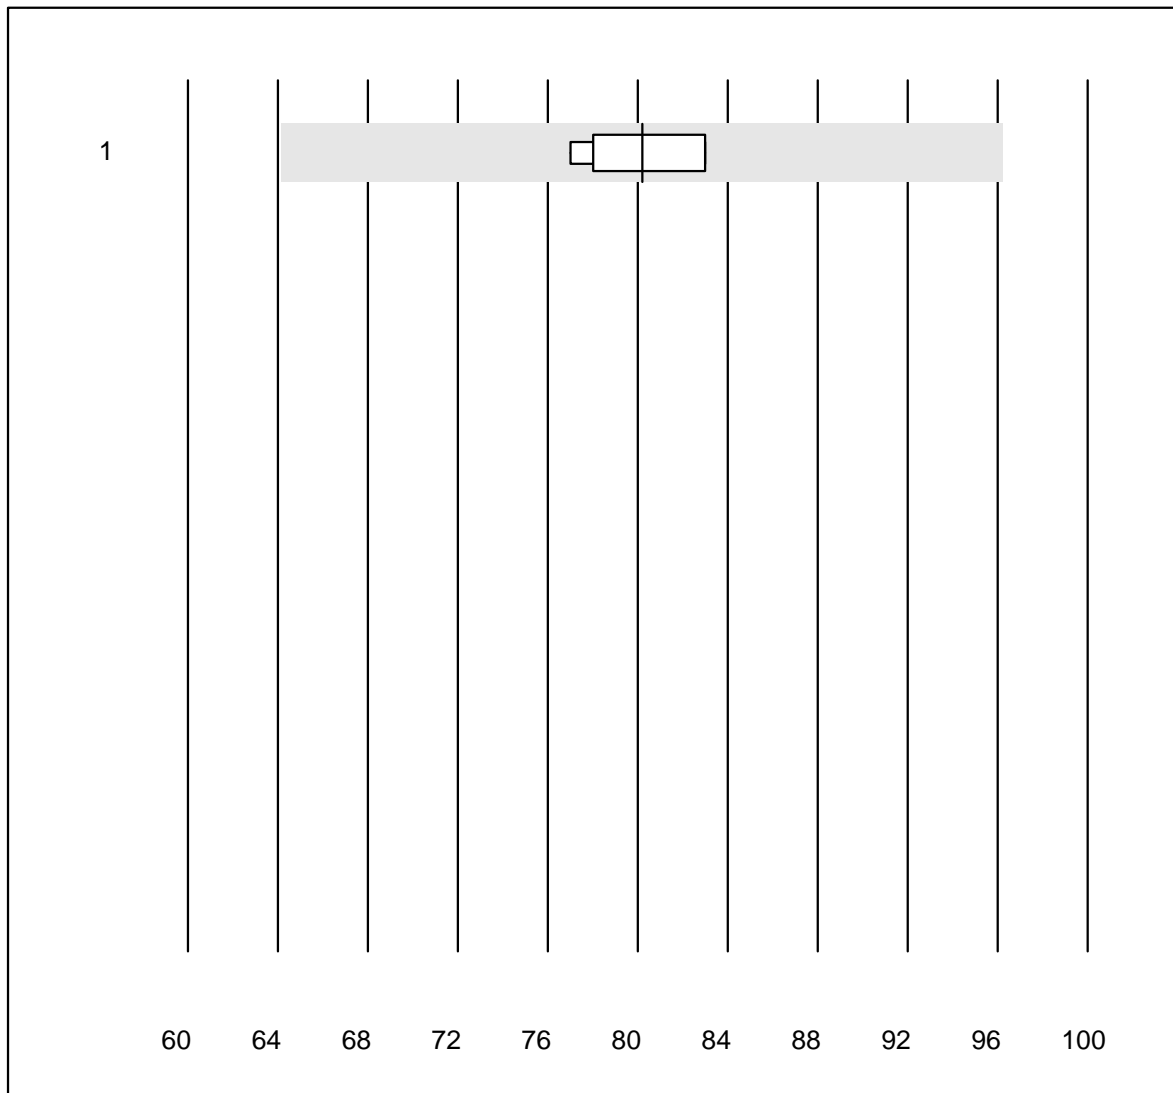


Tolérance MQ : 20 %

FHbF OR (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL90 FLEX / PLUS	10	100.0	0.0	0.0	80.200	3.1	e

Bilirubin OR

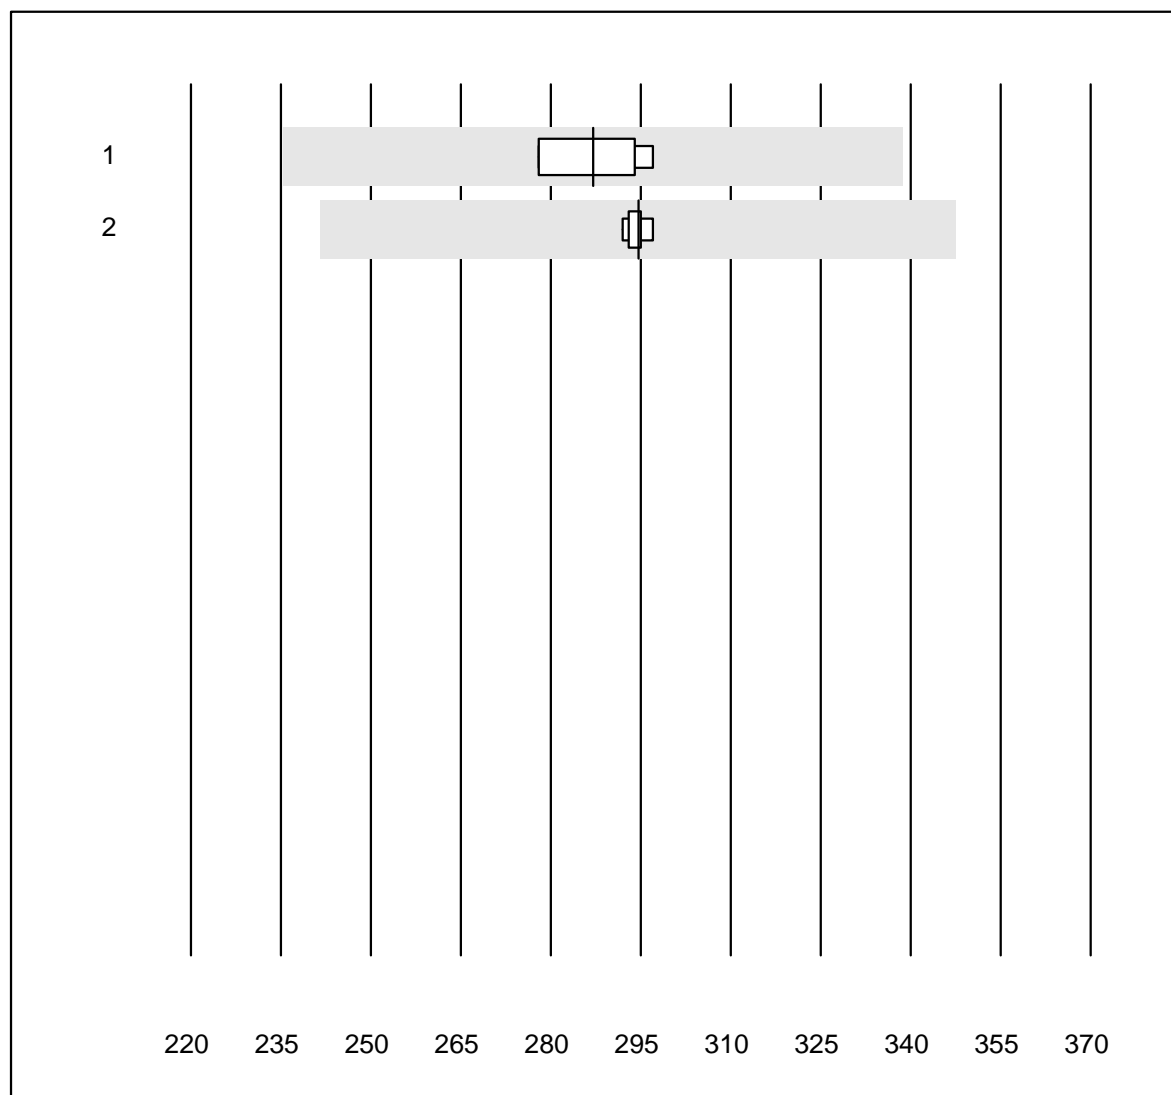


QUALAB Toleranz : 18 %

Bilirubin OR (µmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL700/800	4	100.0	0.0	0.0	287.0	3.4	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	16	100.0	0.0	0.0	294.6	0.6	e

Troponine I

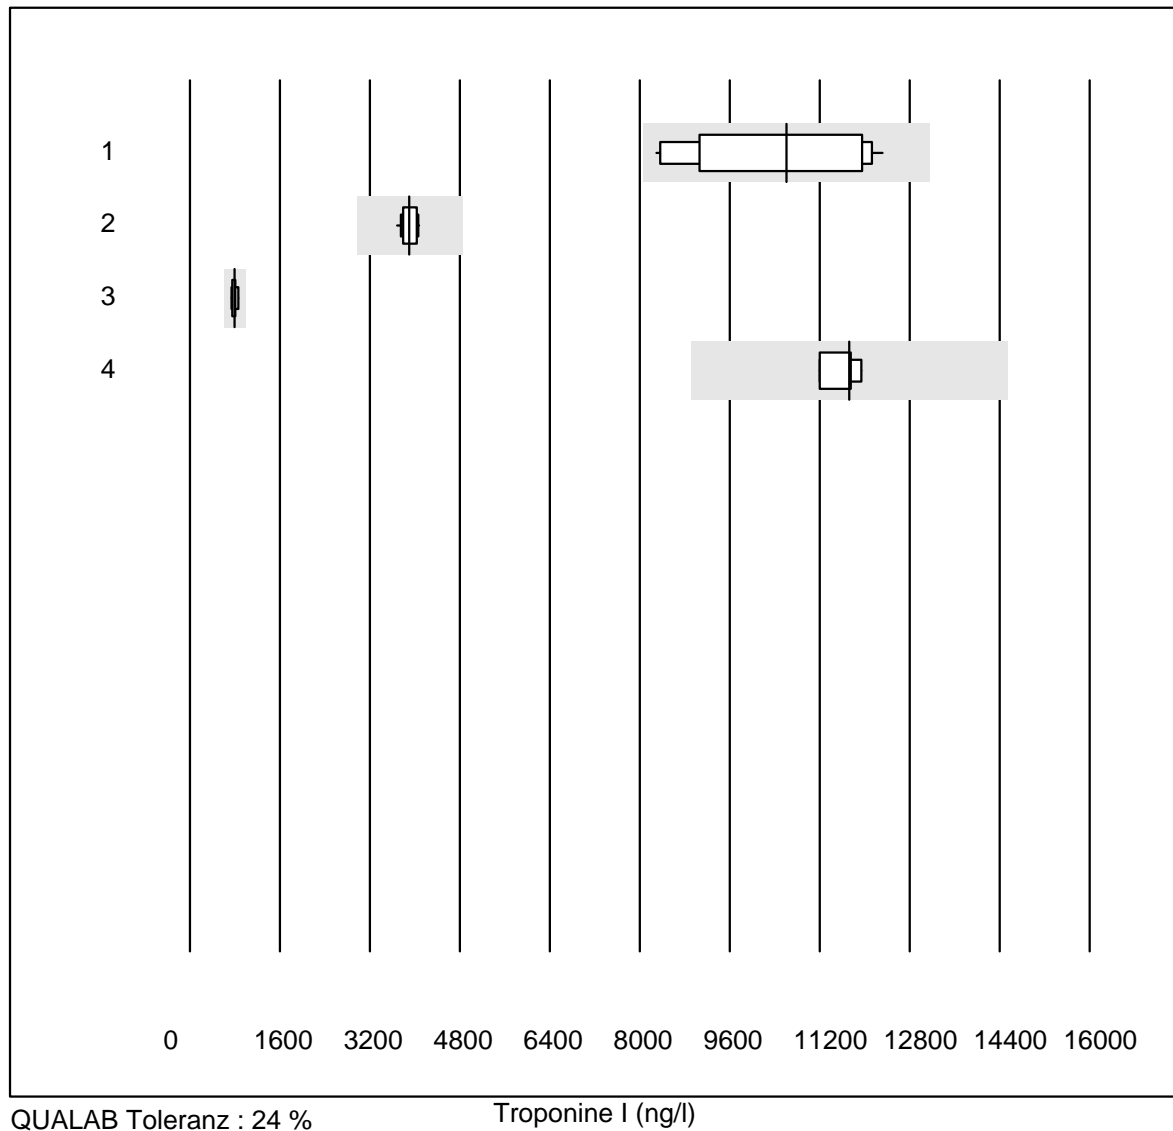

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Vidas	15	100.0	0.0	0.0	10603.3	13.2	e*
2	Architect High Sensi	12	91.7	0.0	8.3	3905.1	3.2	e
3	AQT 90 FLEX	6	83.3	0.0	16.7	790.0	6.1	e
4	ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	11722.5	2.7	e

Troponine T

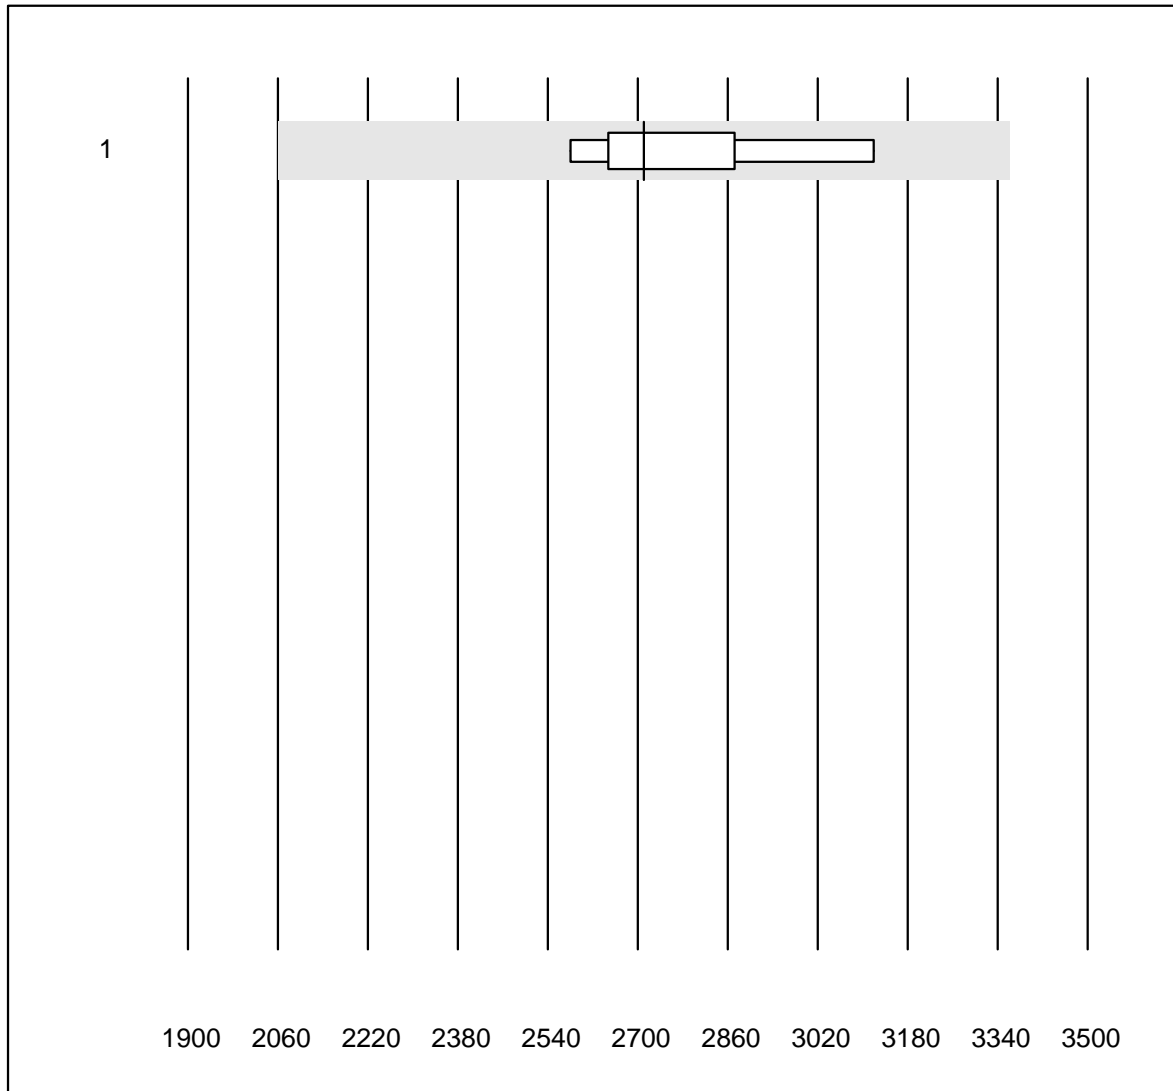


QUALAB Toleranz : 24 %

Troponine T (ng/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas hs STAT	9	100.0	0.0	0.0	2711.00	6.1	e

Myoglobine

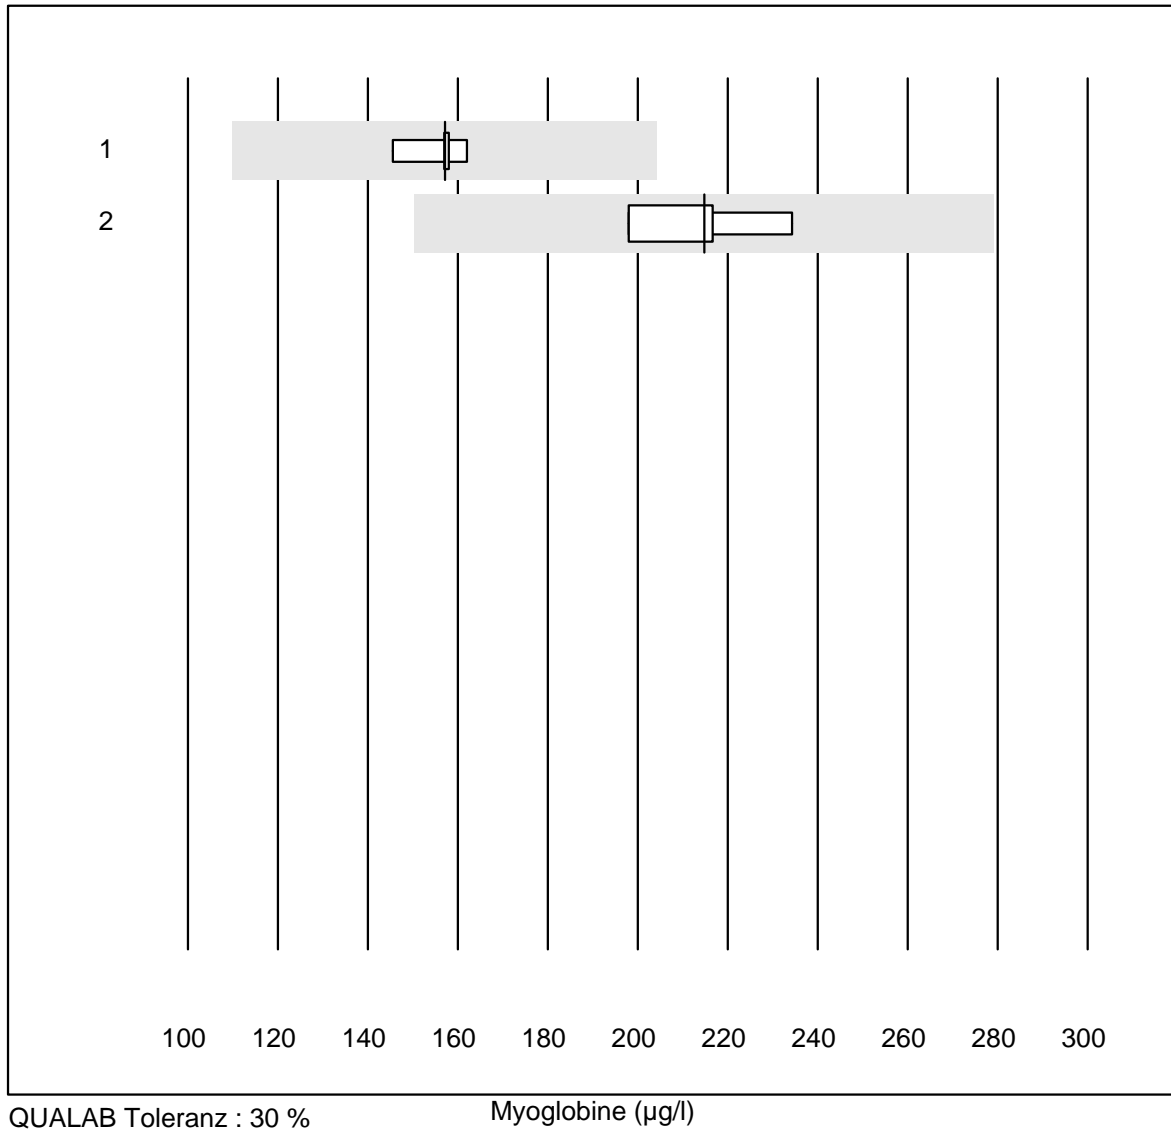

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	5	100.0	0.0	0.0	157.1	3.9	e
2	Architect	4	100.0	0.0	0.0	214.8	6.9	e

masse CK-MB

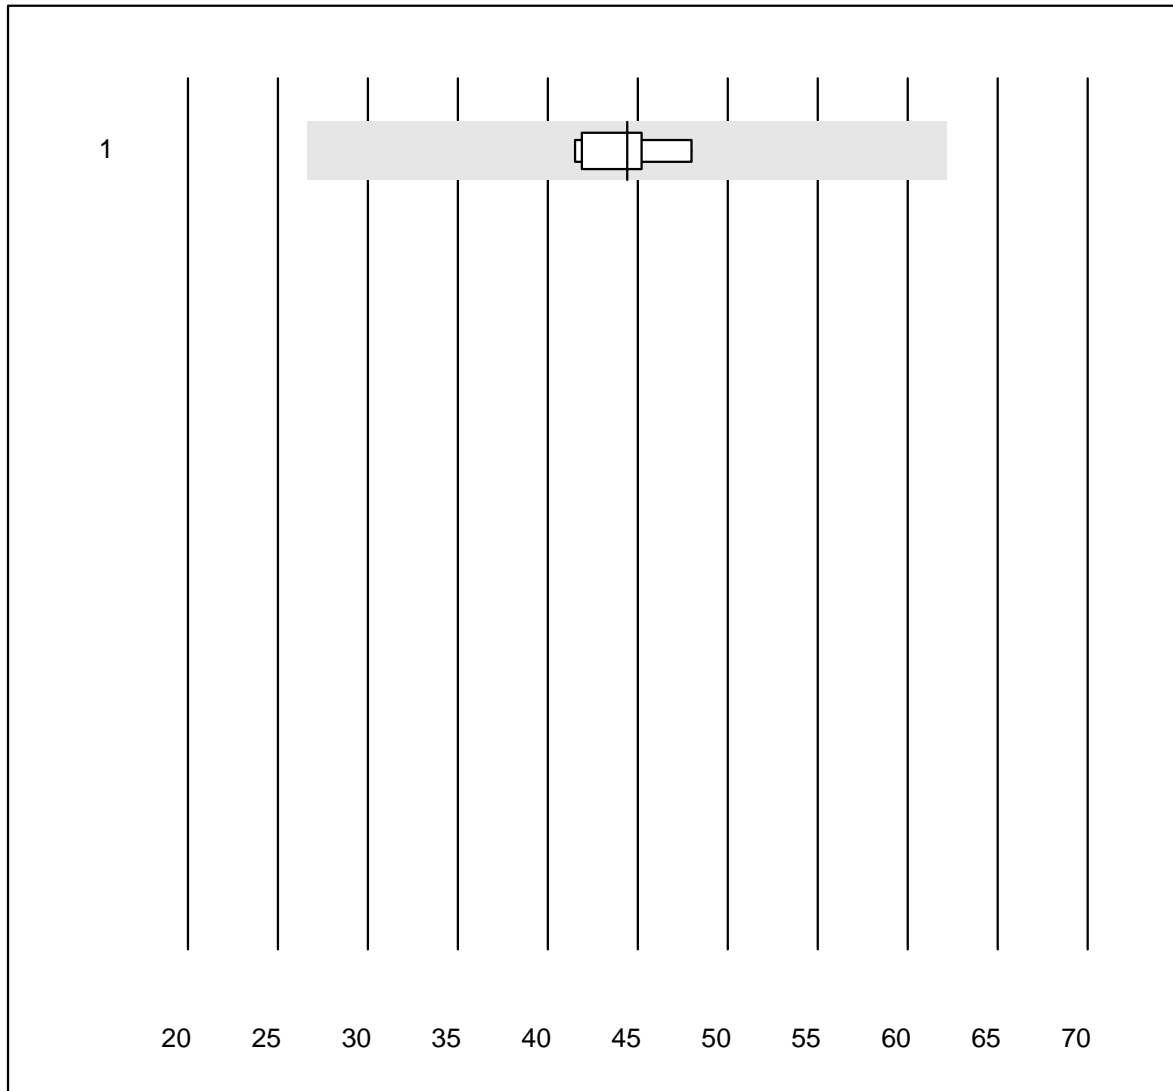


Tolérance MQ : 40 %

masse CK-MB (µg/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Architect	5	100.0	0.0	0.0	44.4	6.0	e

NT-proBNP

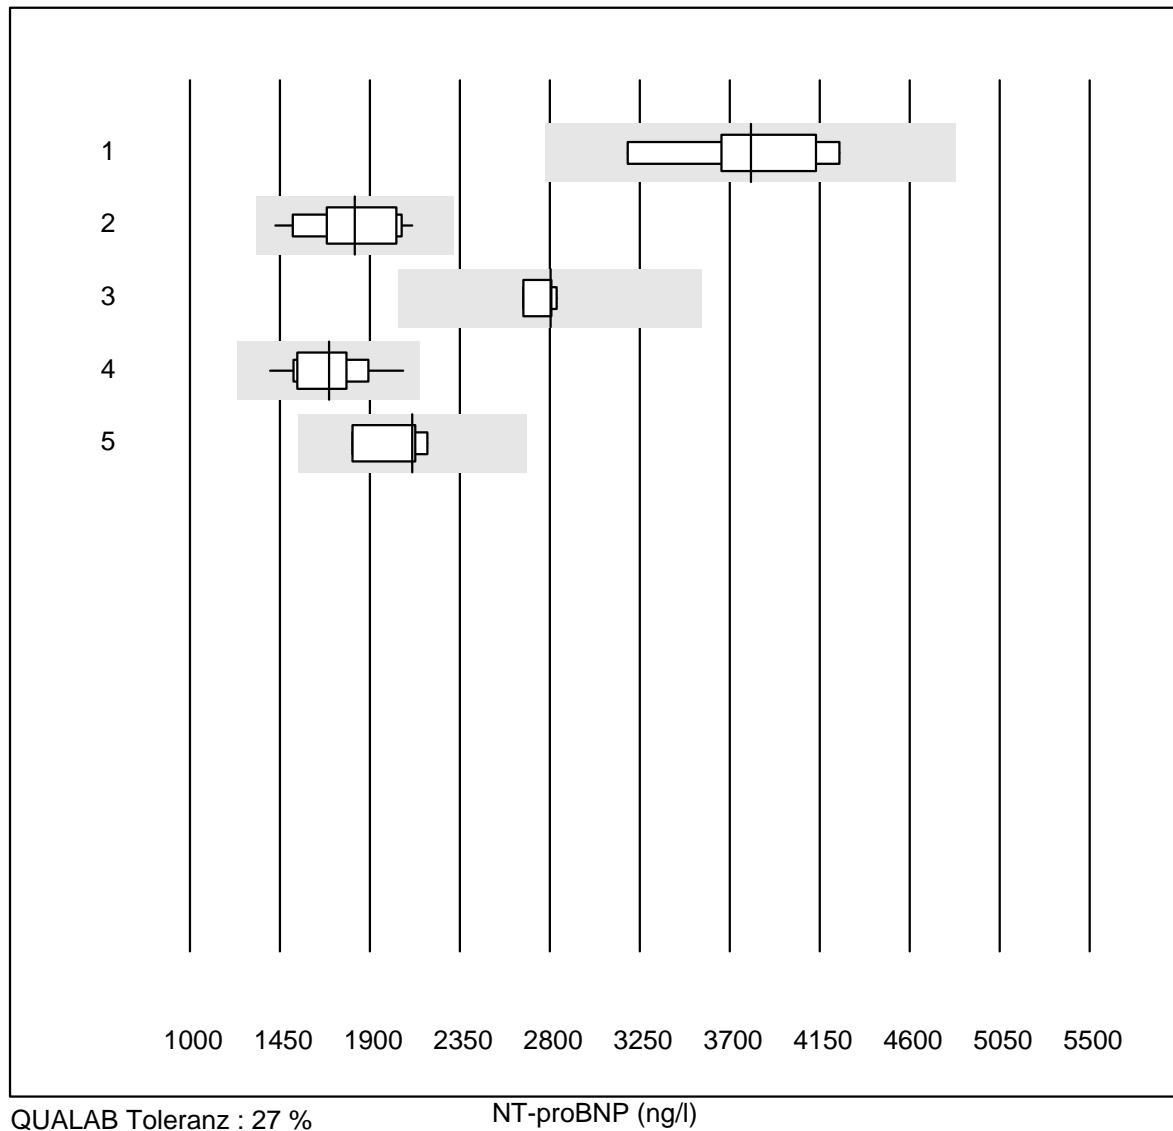


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 AQT 90 FLEX	6	100.0	0.0	0.0	3805.0	10.0	e*
2 VIDAS	11	100.0	0.0	0.0	1825.3	12.1	e*
3 Autres méthodes	5	80.0	0.0	20.0	2802.0	2.7	e
4 Cobas E / Elecsys	12	100.0	0.0	0.0	1694.0	10.9	e
5 Architect	4	100.0	0.0	0.0	2111.9	8.0	e*

TSH

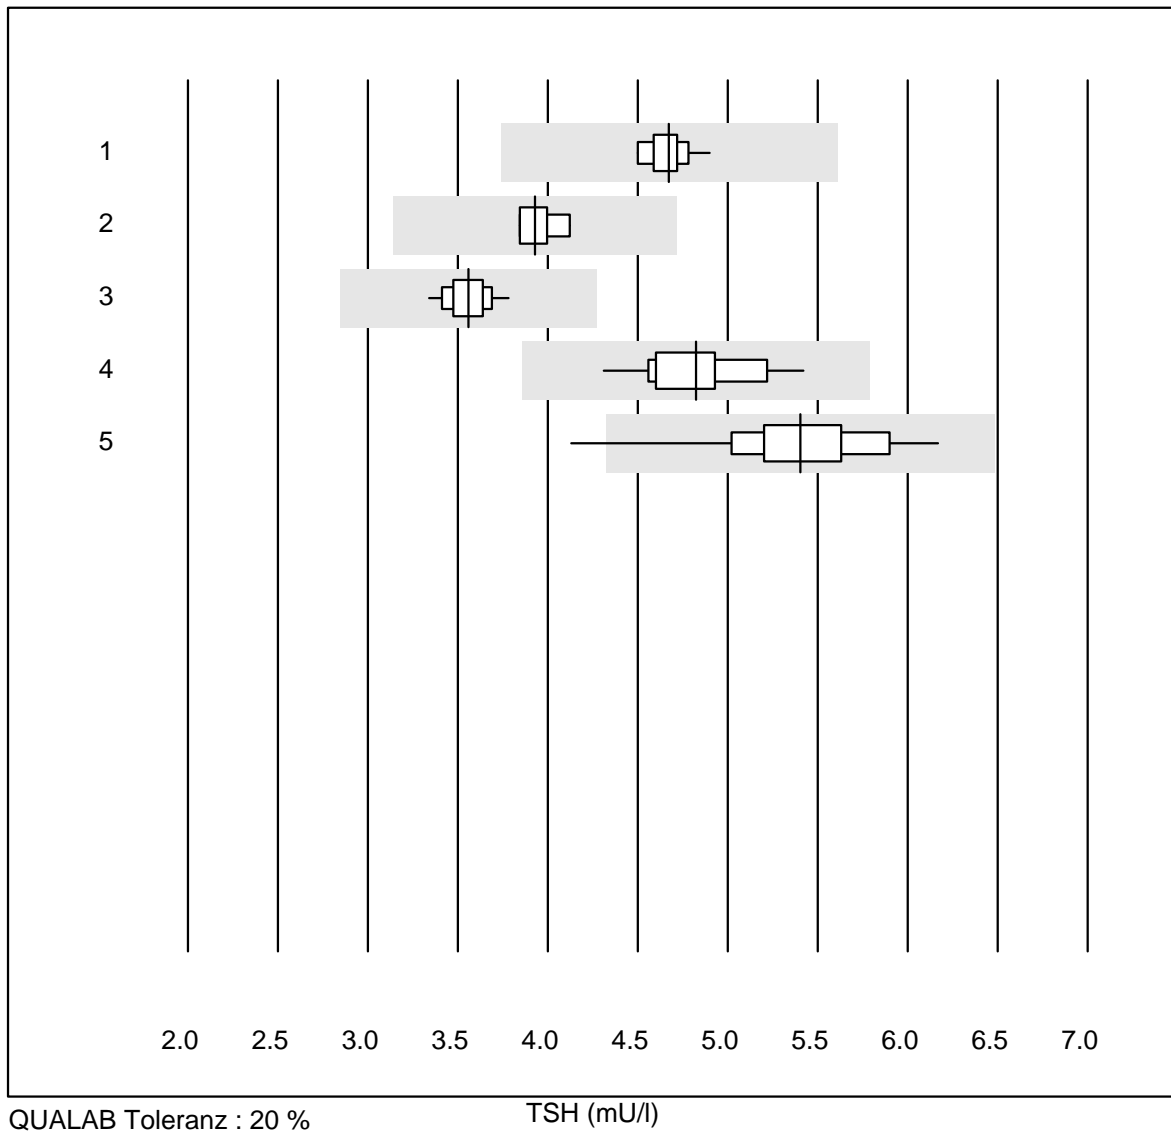


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	12	100.0	0.0	0.0	4.67	2.5	e
2	ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	3.93	3.3	e
3	Architect	14	100.0	0.0	0.0	3.56	3.3	e
4	VIDAS	15	100.0	0.0	0.0	4.83	5.8	e
5	AFIAS	37	97.3	2.7	0.0	5.40	7.2	e

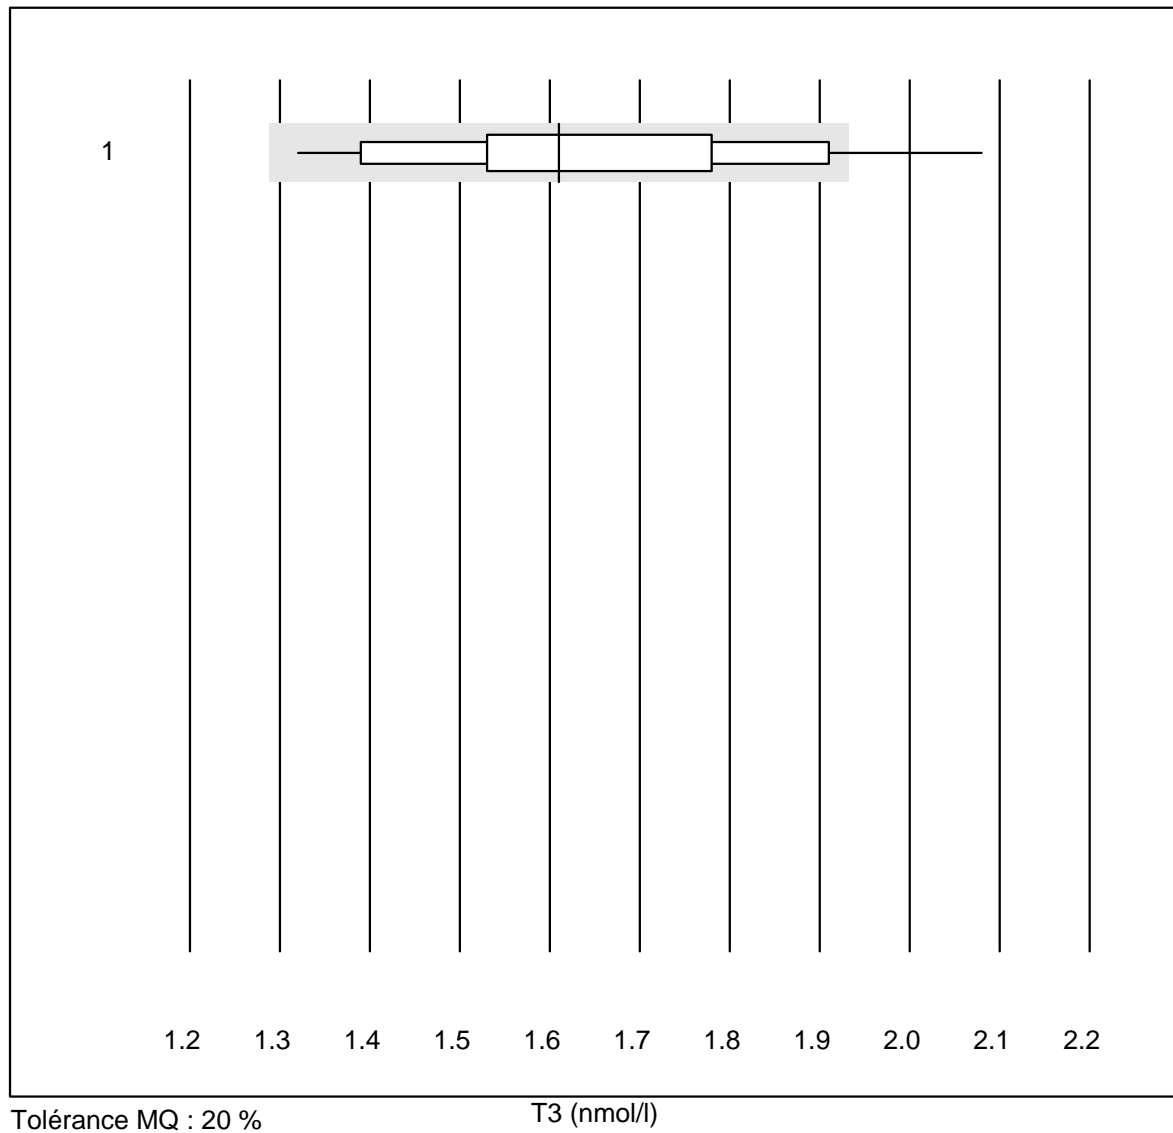T3

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 AFIAS	14	92.9	7.1	0.0	1.6	12.4	e*

T4

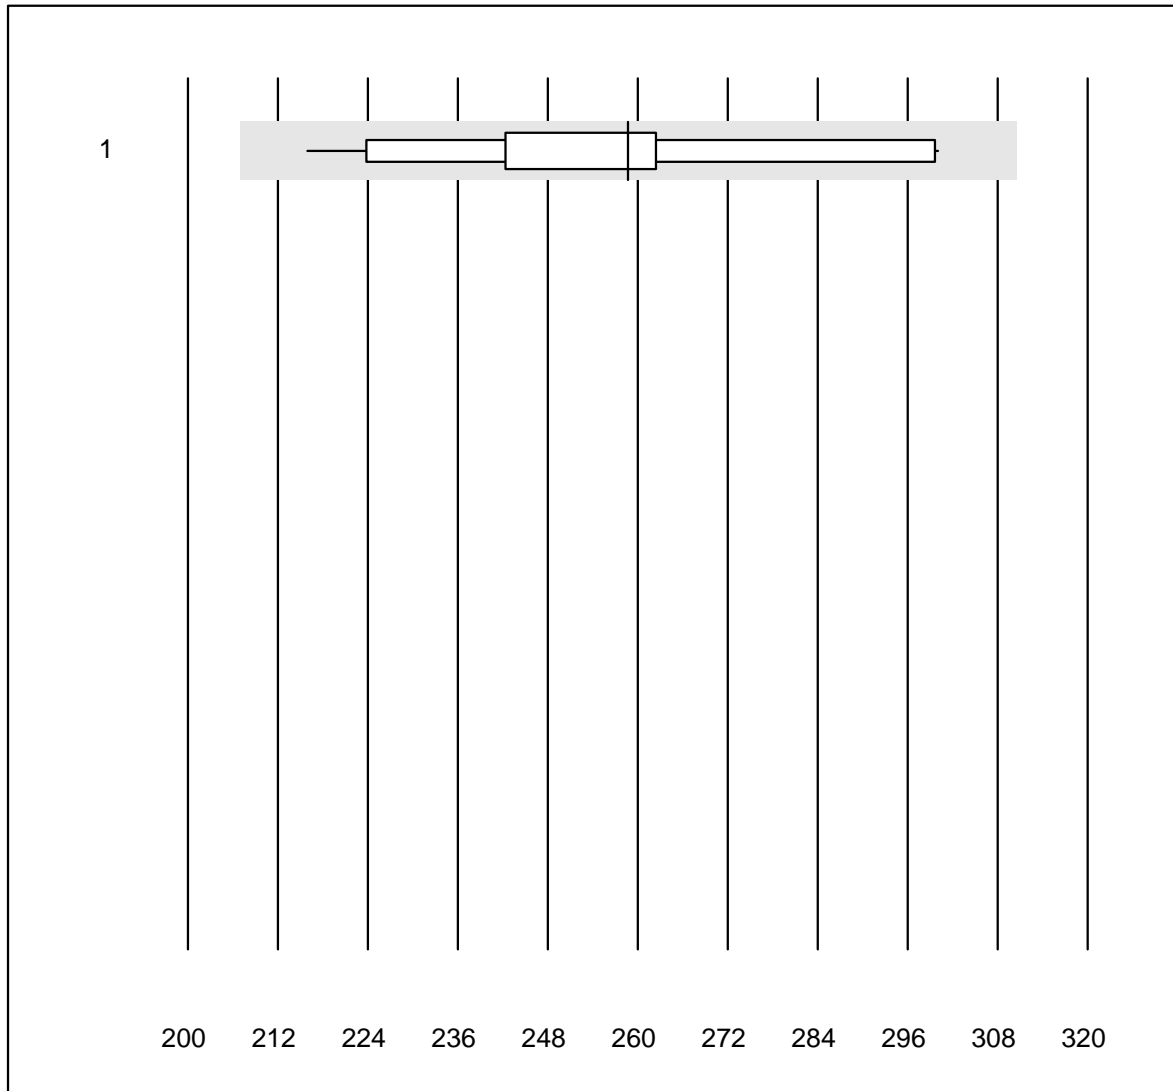


Tolérance MQ : 20 %


T4 (nmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 AFIAS	16	100.0	0.0	0.0	259	9.1	e

FT3

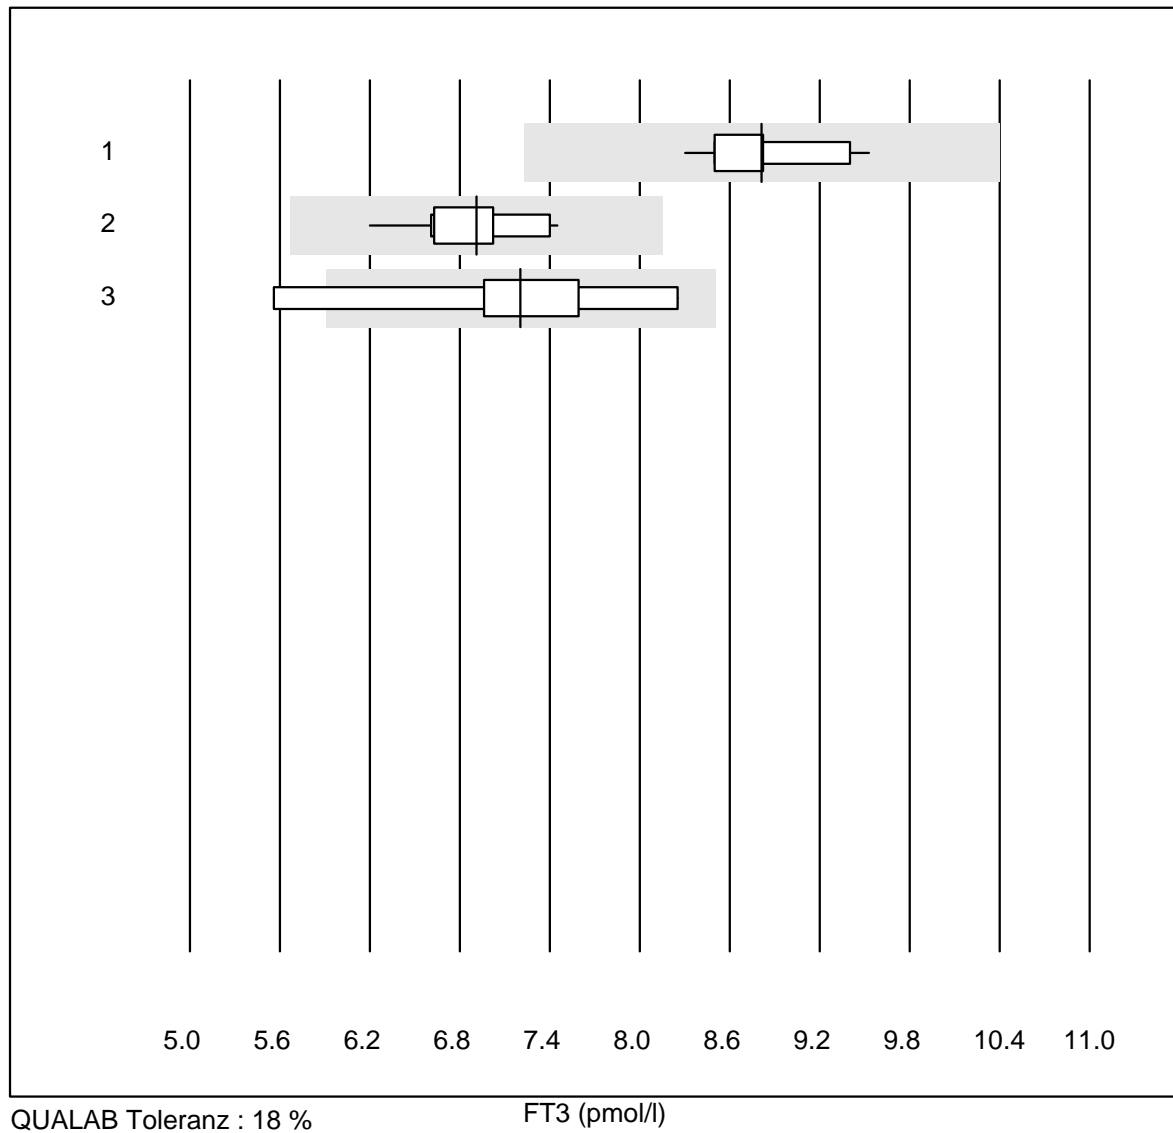


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	12	100.0	0.0	0.0	8.8	4.3	e
2 Architect	12	100.0	0.0	0.0	6.9	5.4	e
3 VIDAS	8	87.5	12.5	0.0	7.2	11.3	e*

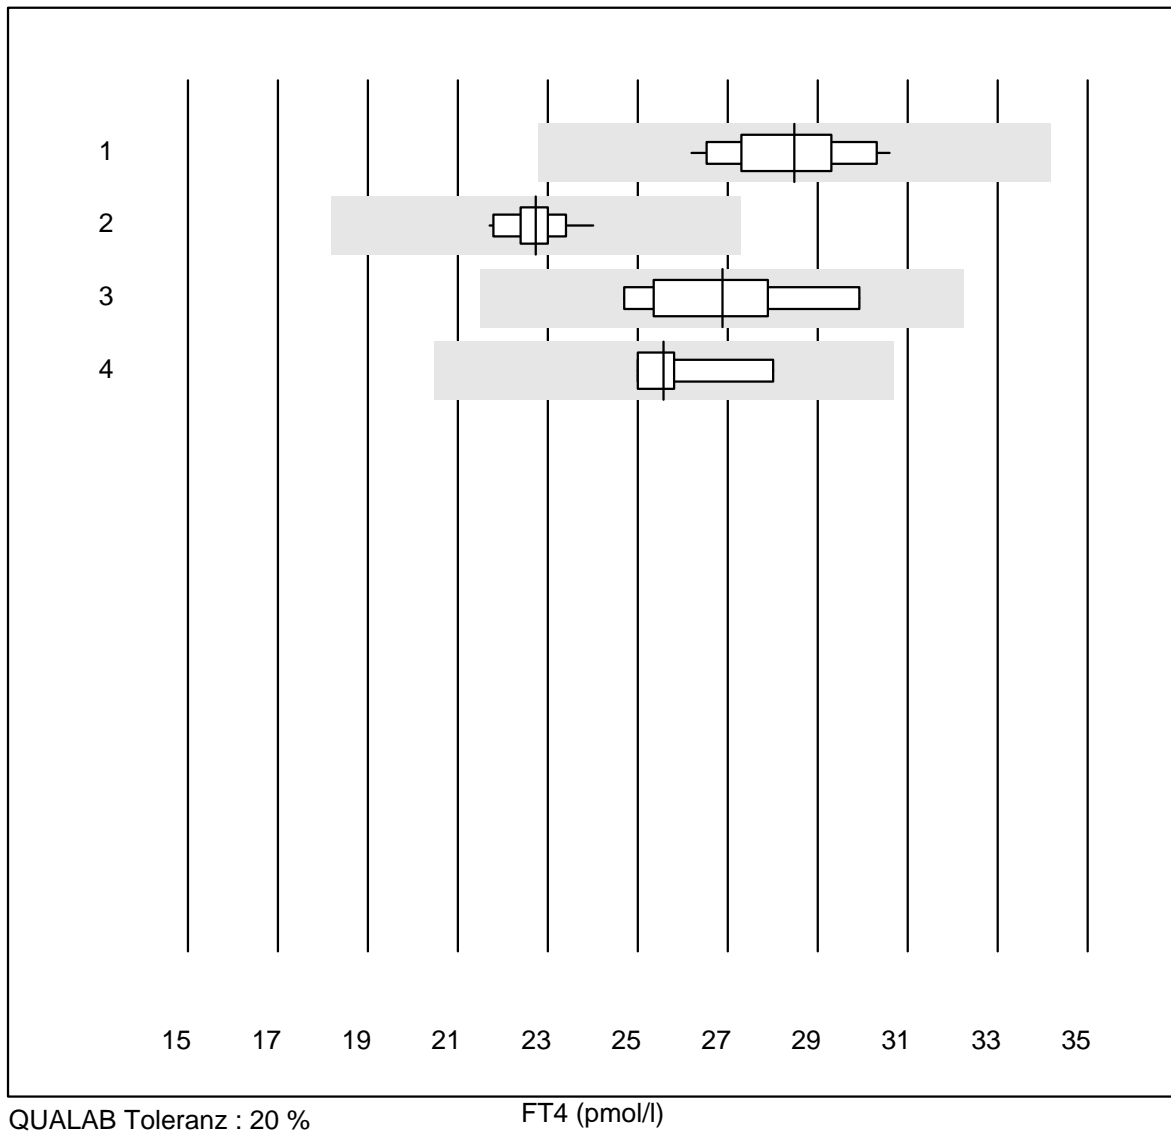FT4

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	13	100.0	0.0	0.0	28.5	4.9	e
2 Architect	14	100.0	0.0	0.0	22.7	2.7	e
3 VIDAS	8	100.0	0.0	0.0	26.9	6.6	e
4 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	25.6	5.2	e*

Testostérone

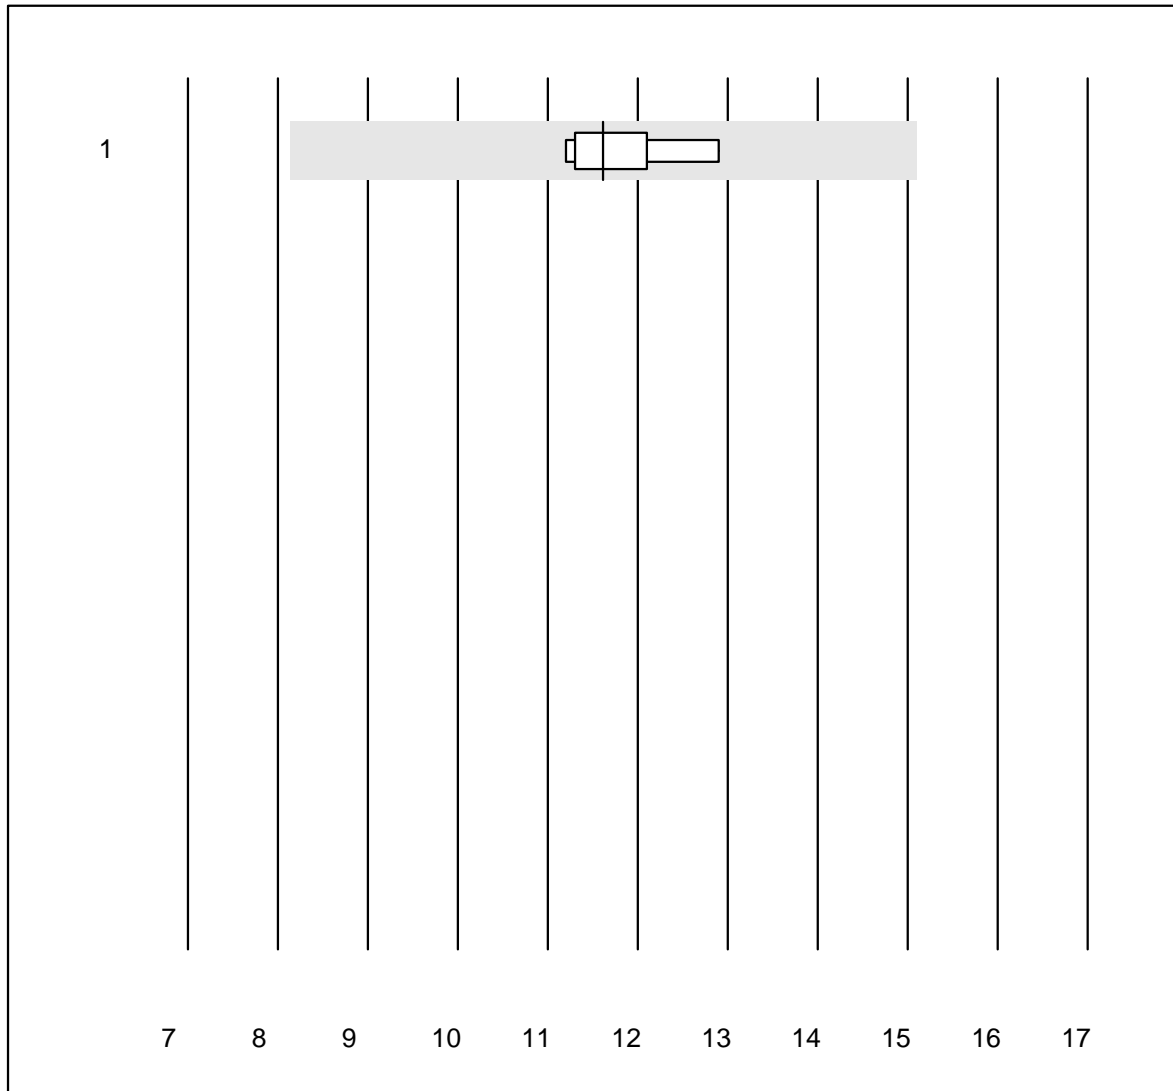


QUALAB Toleranz : 30 %

Testostérone (nmol/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Architect	6	100.0	0.0	0.0	12	5.4	e

Estradiol

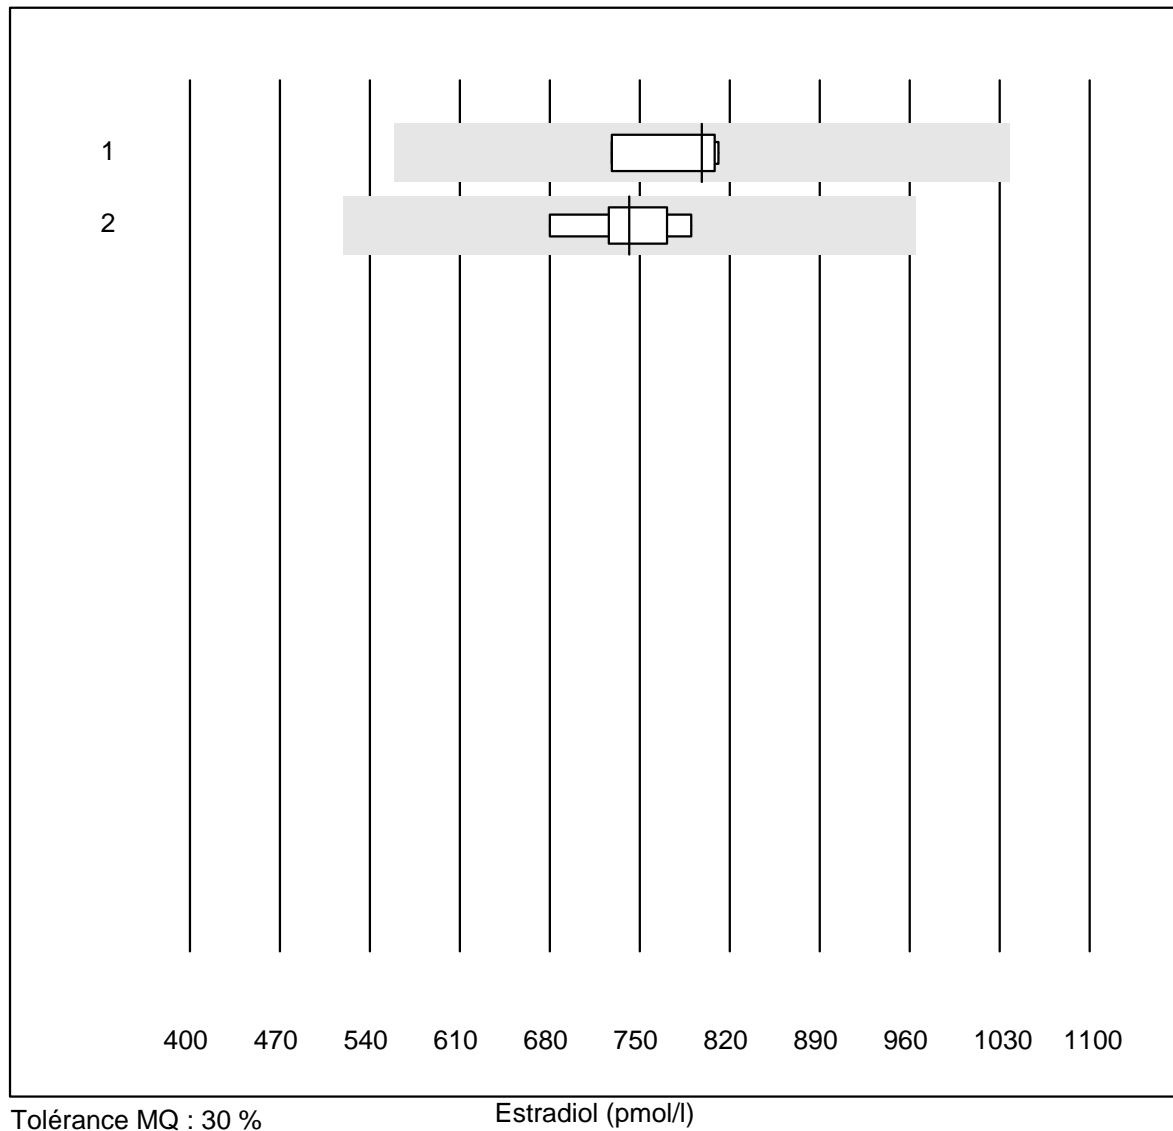


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	5	80.0	0.0	20.0	798	5.0	a
2 Architect	7	100.0	0.0	0.0	742	4.8	e

SHBG

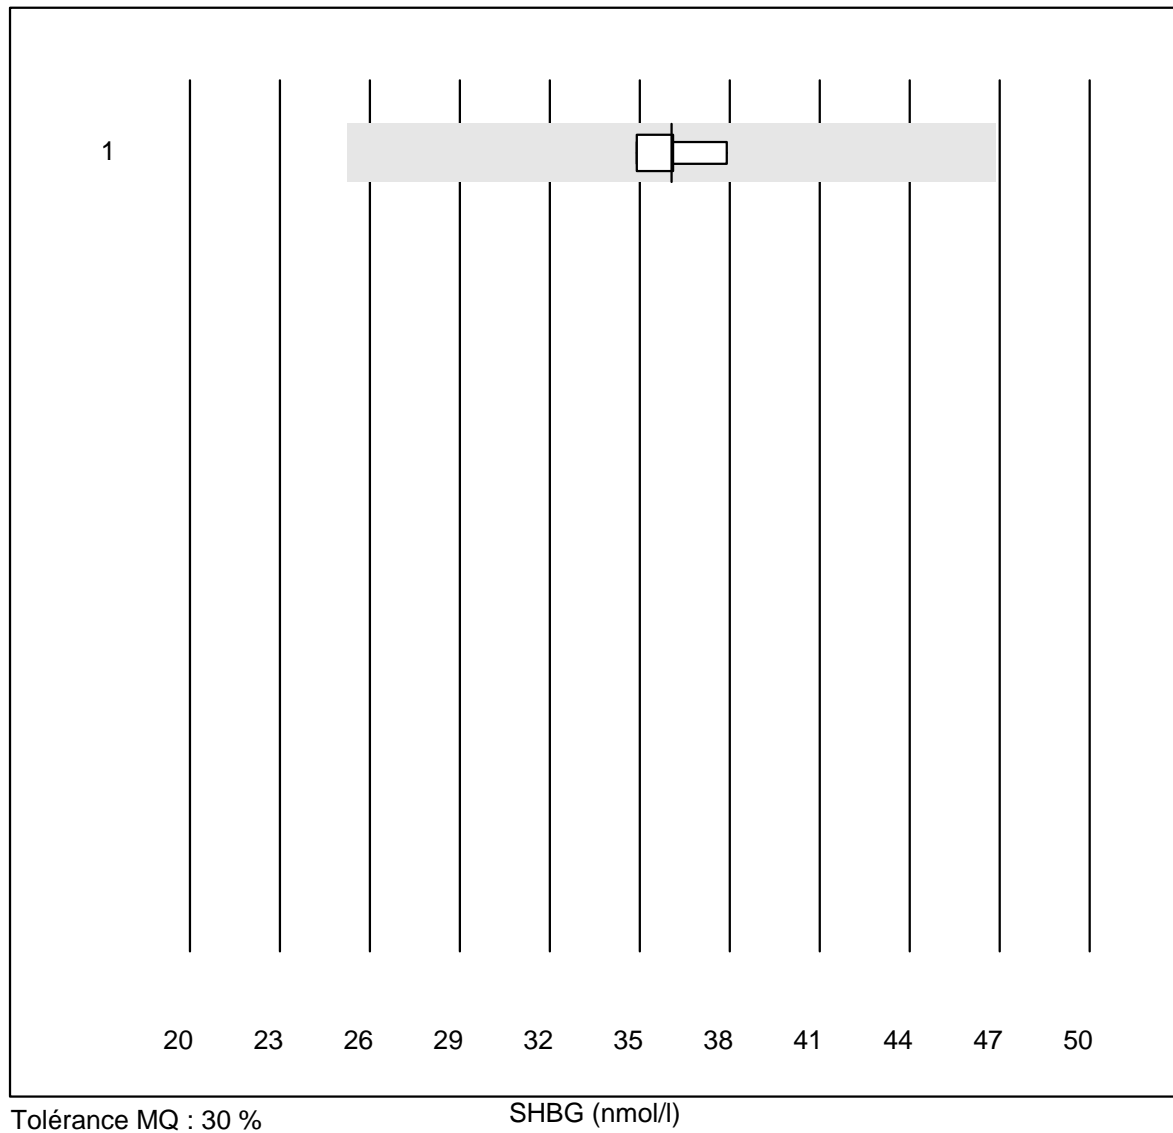

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	36.1	3.4	e

Cortisol

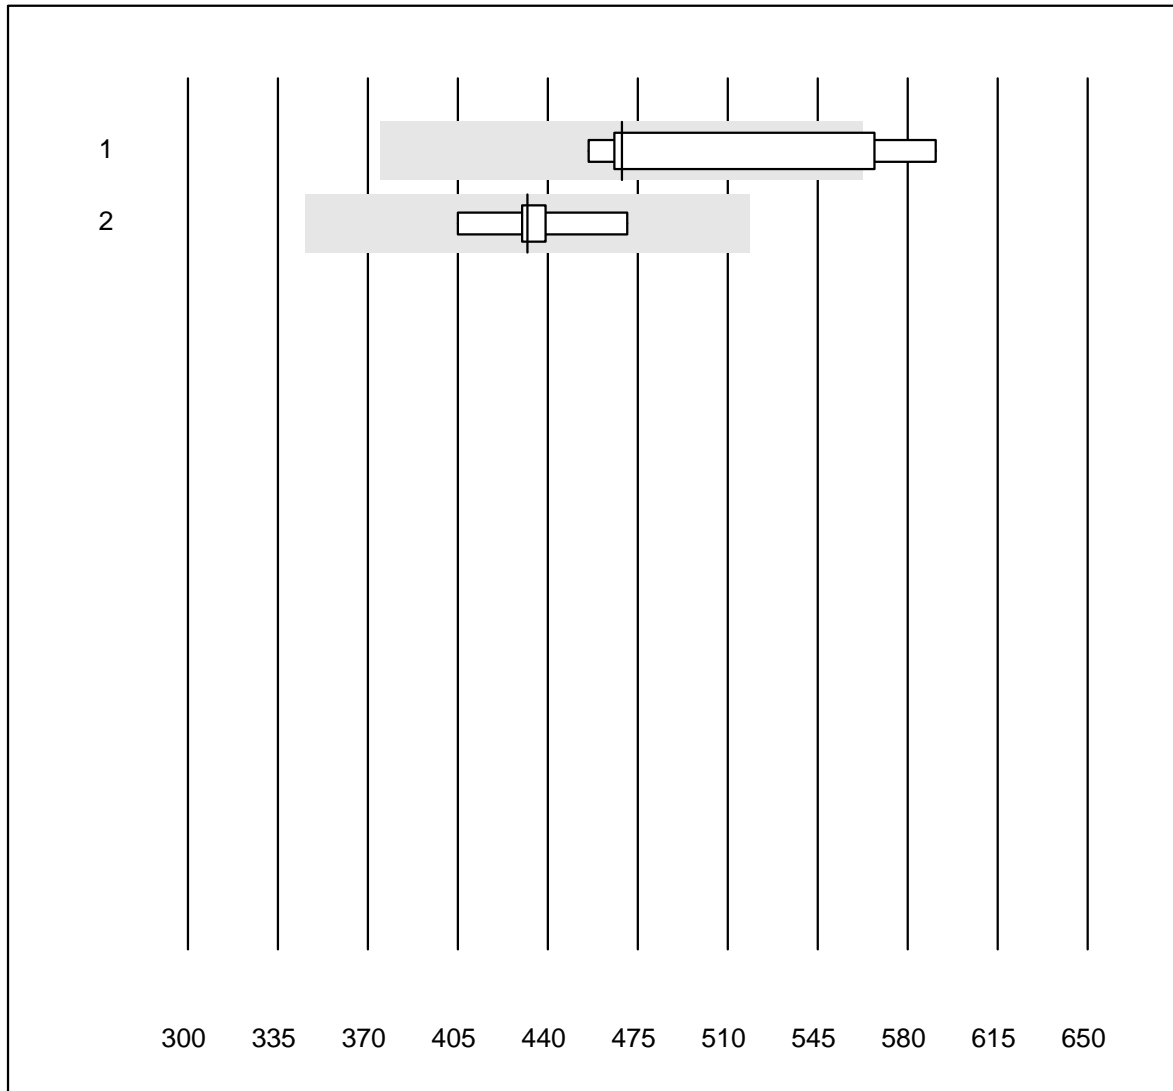


QUALAB Toleranz : 20 %

Cortisol (nmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	7	71.4	28.6	0.0	469	11.1	e*
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	432	5.4	e*

Progesteron

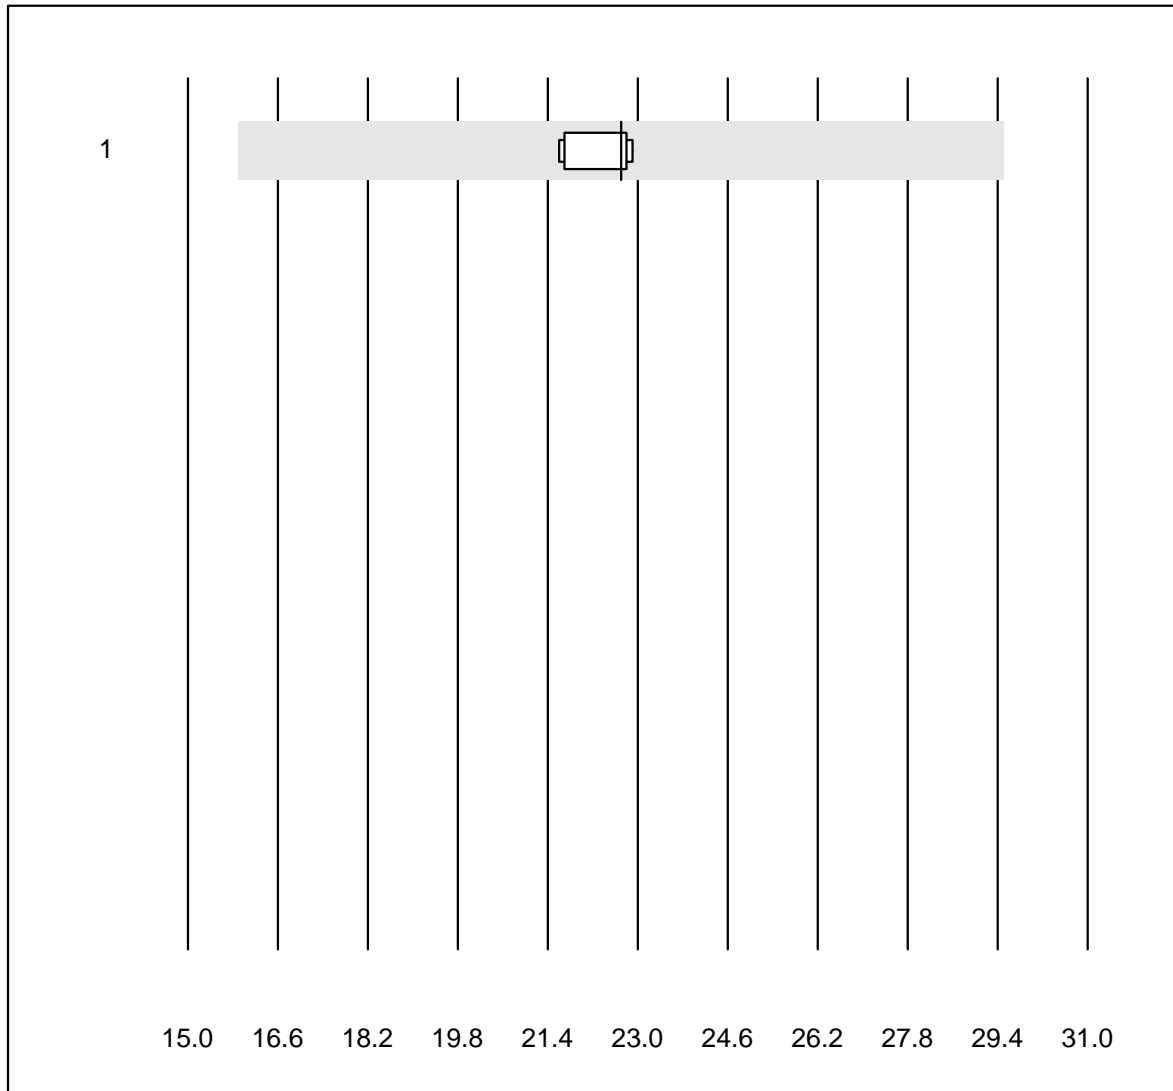


Tolérance MQ : 30 %

Progesteron (nmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Architect	6	100.0	0.0	0.0	22.7	2.6	e

DHEAS

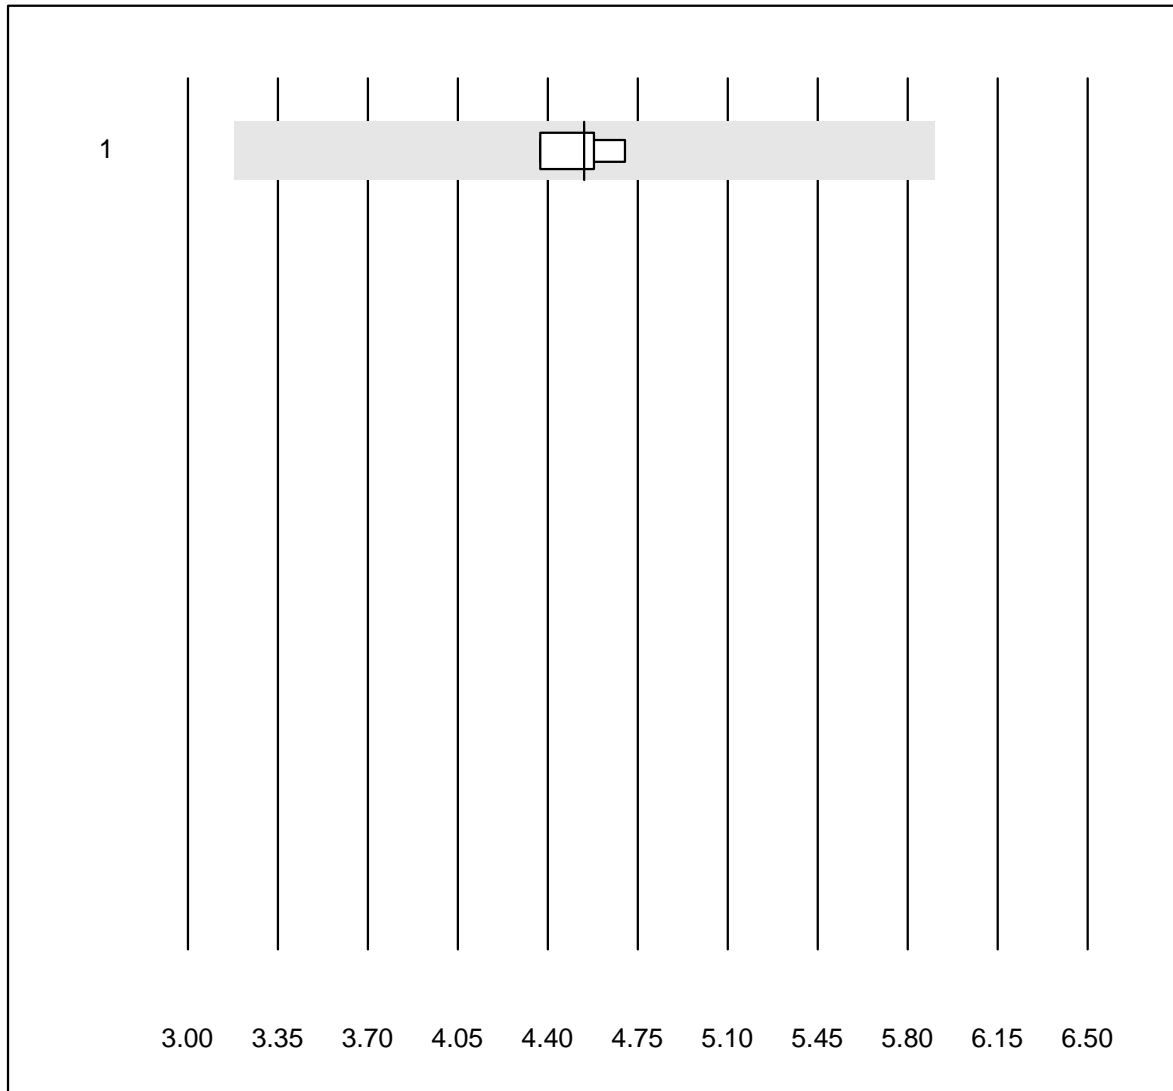


Tolérance MQ : 30 %

DHEAS (µmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	4.54	3.1	e

Luteinisierendes Hormon

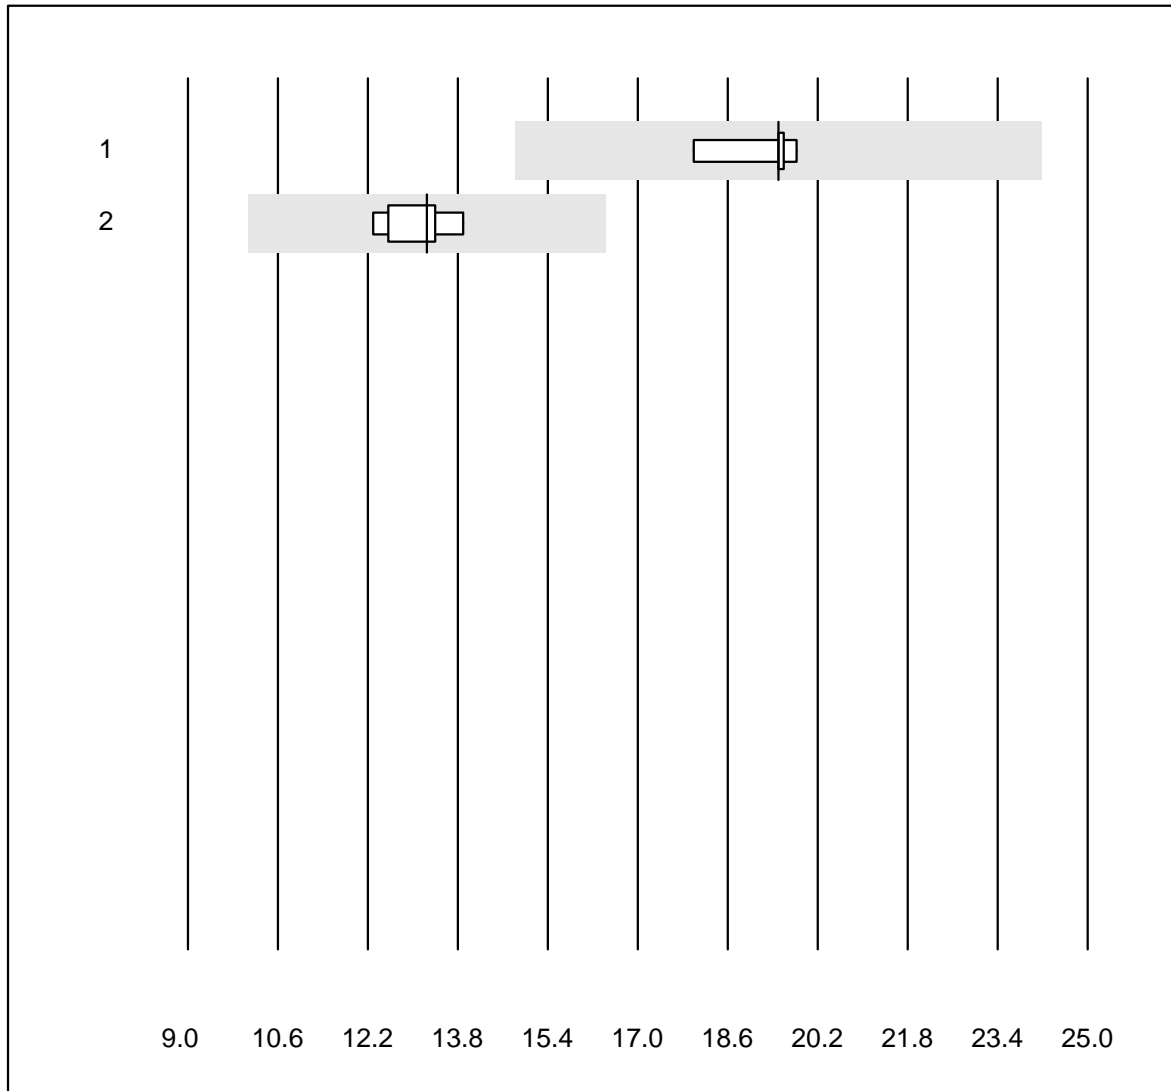


QUALAB Toleranz : 24 %

Luteinisierendes Hormon (U/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Roche, Cobas	5	100.0	0.0	0.0	19.5	3.8	e
2	Architect	6	100.0	0.0	0.0	13.3	4.5	e

Follikelstimulierendes Hormon

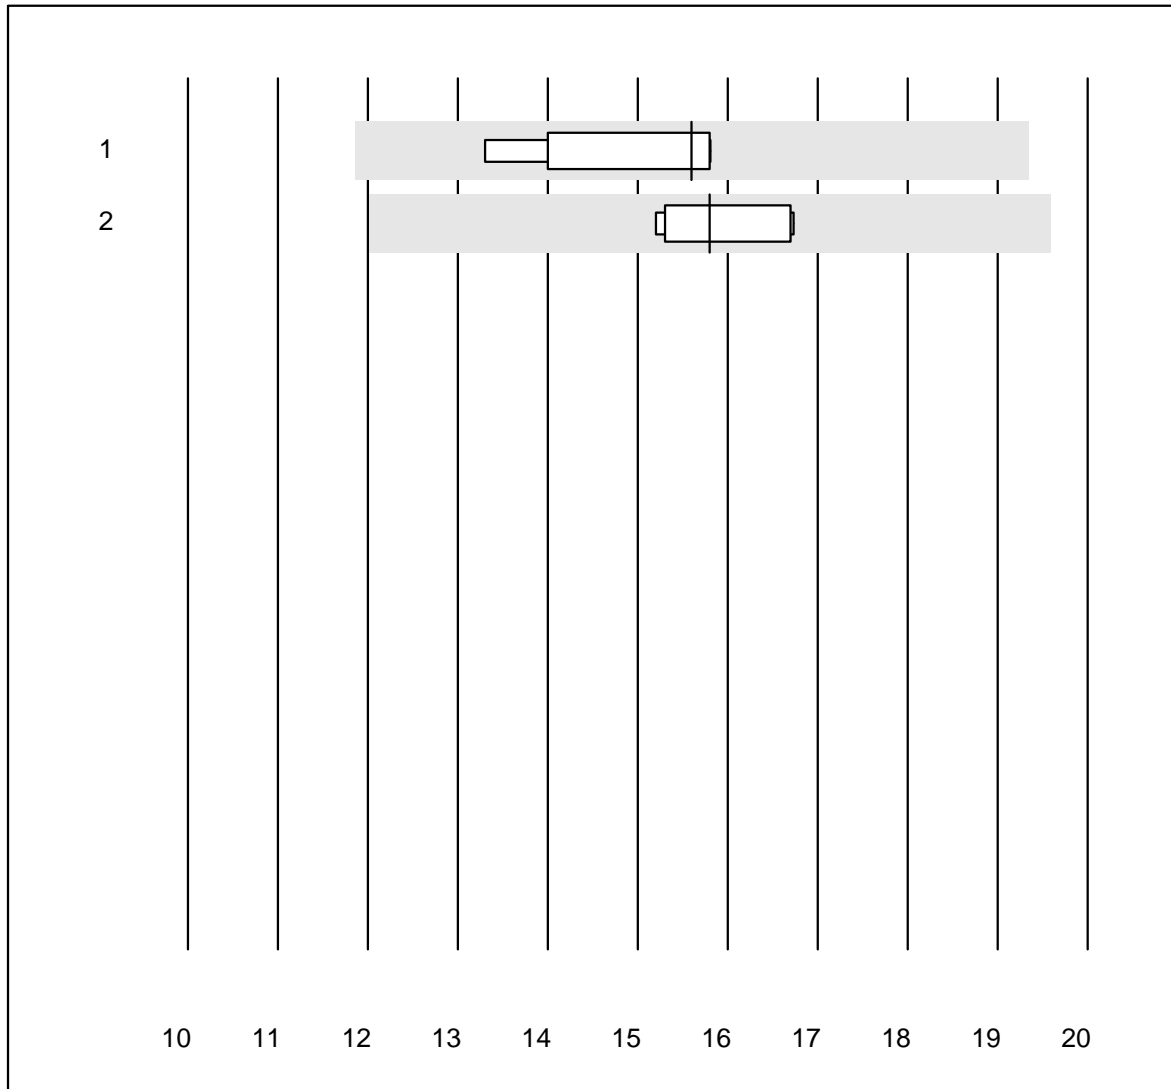


QUALAB Toleranz : 24 %

Follikelstimulierendes Hormon (U/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Roche, Cobas	5	100.0	0.0	0.0	15.6	7.9	e*
2	Architect	7	100.0	0.0	0.0	15.8	3.8	e

Prolaktin (PRL)

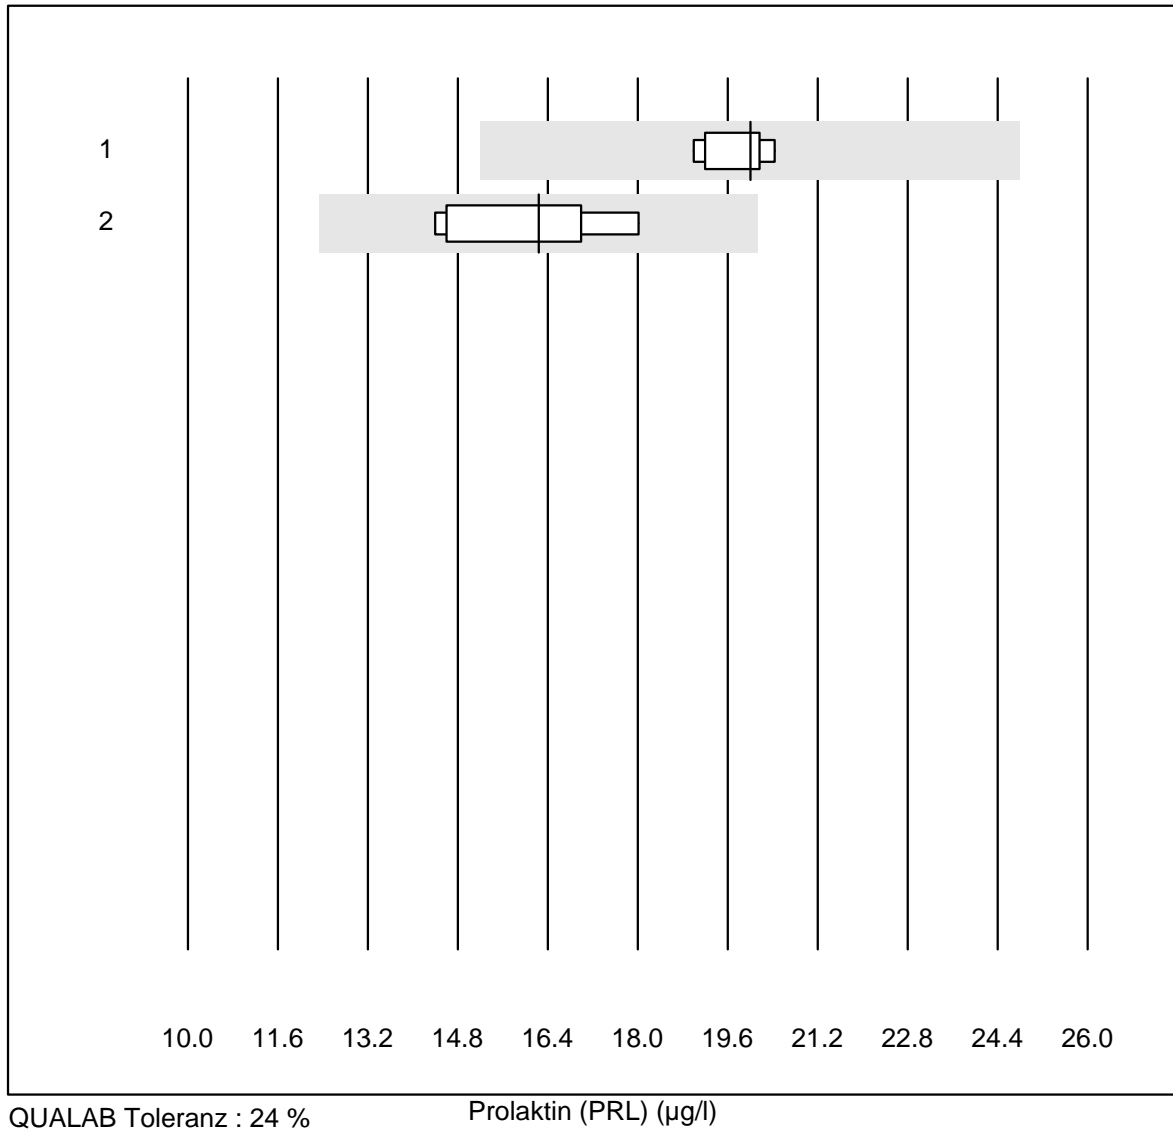

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas/Roche	5	100.0	0.0	0.0	20.0	3.2	e
2 Architect	6	100.0	0.0	0.0	16.2	8.6	e*

HGH

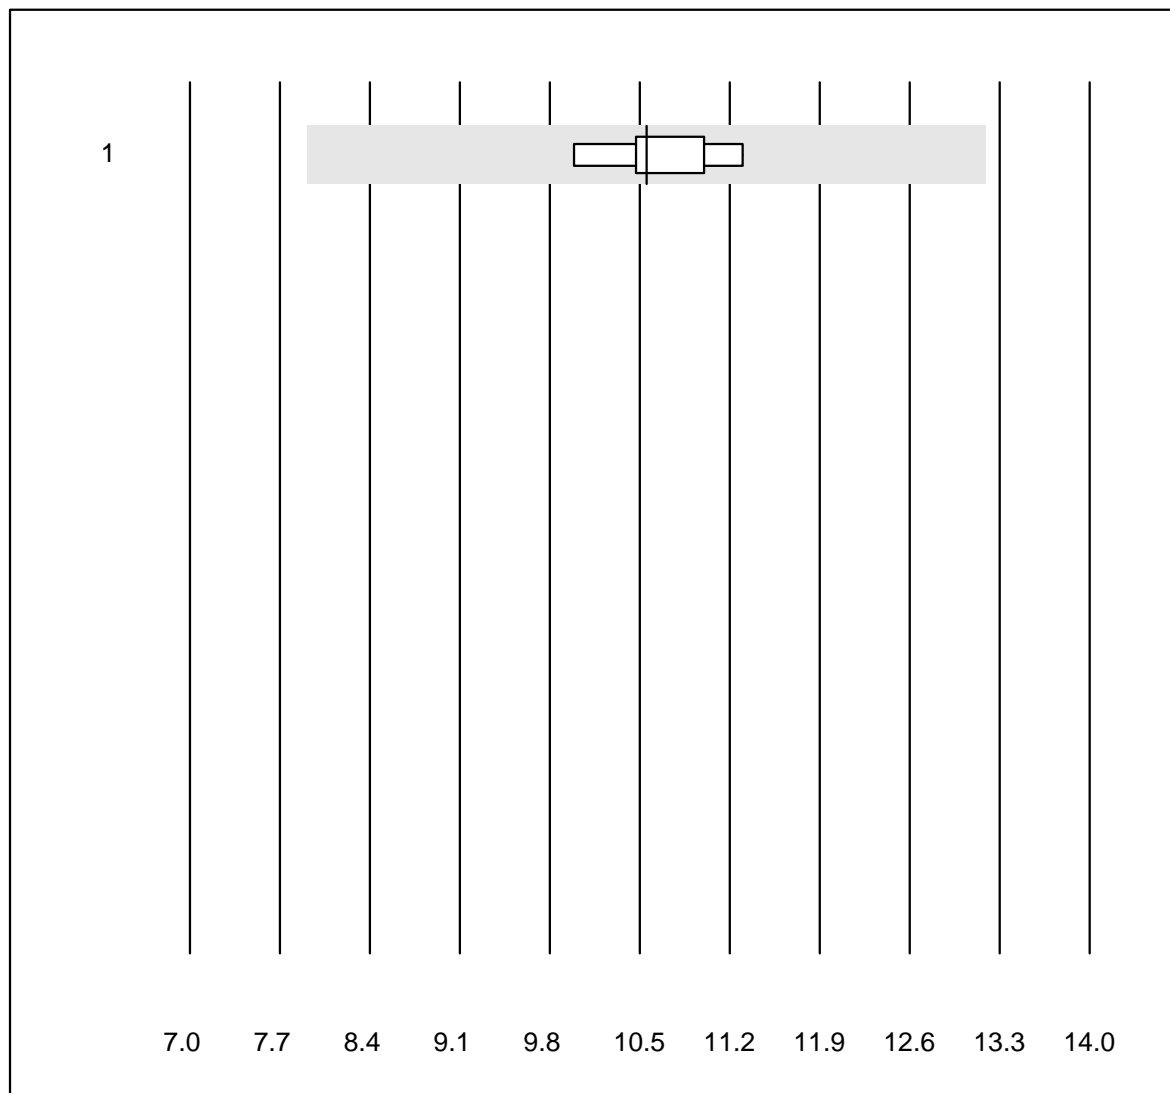


Tolérance MQ : 25 %

HGH (µg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	10.55	4.3	e

IGF-1

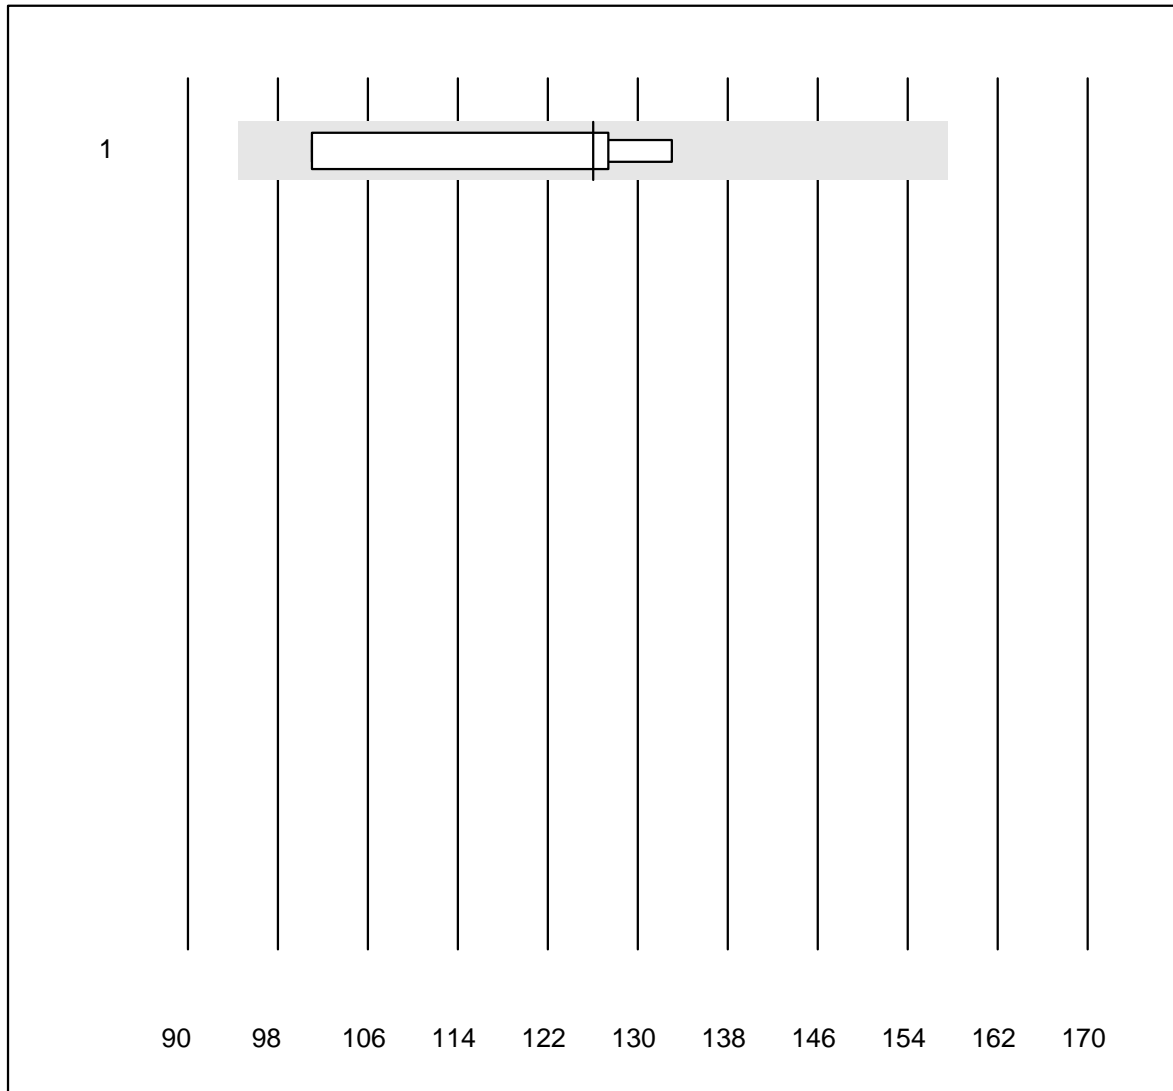


Tolérance MQ : 25 %

IGF-1 (µg/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Liaison	4	100.0	0.0	0.0	126	11.6	e*

Troponine T CR

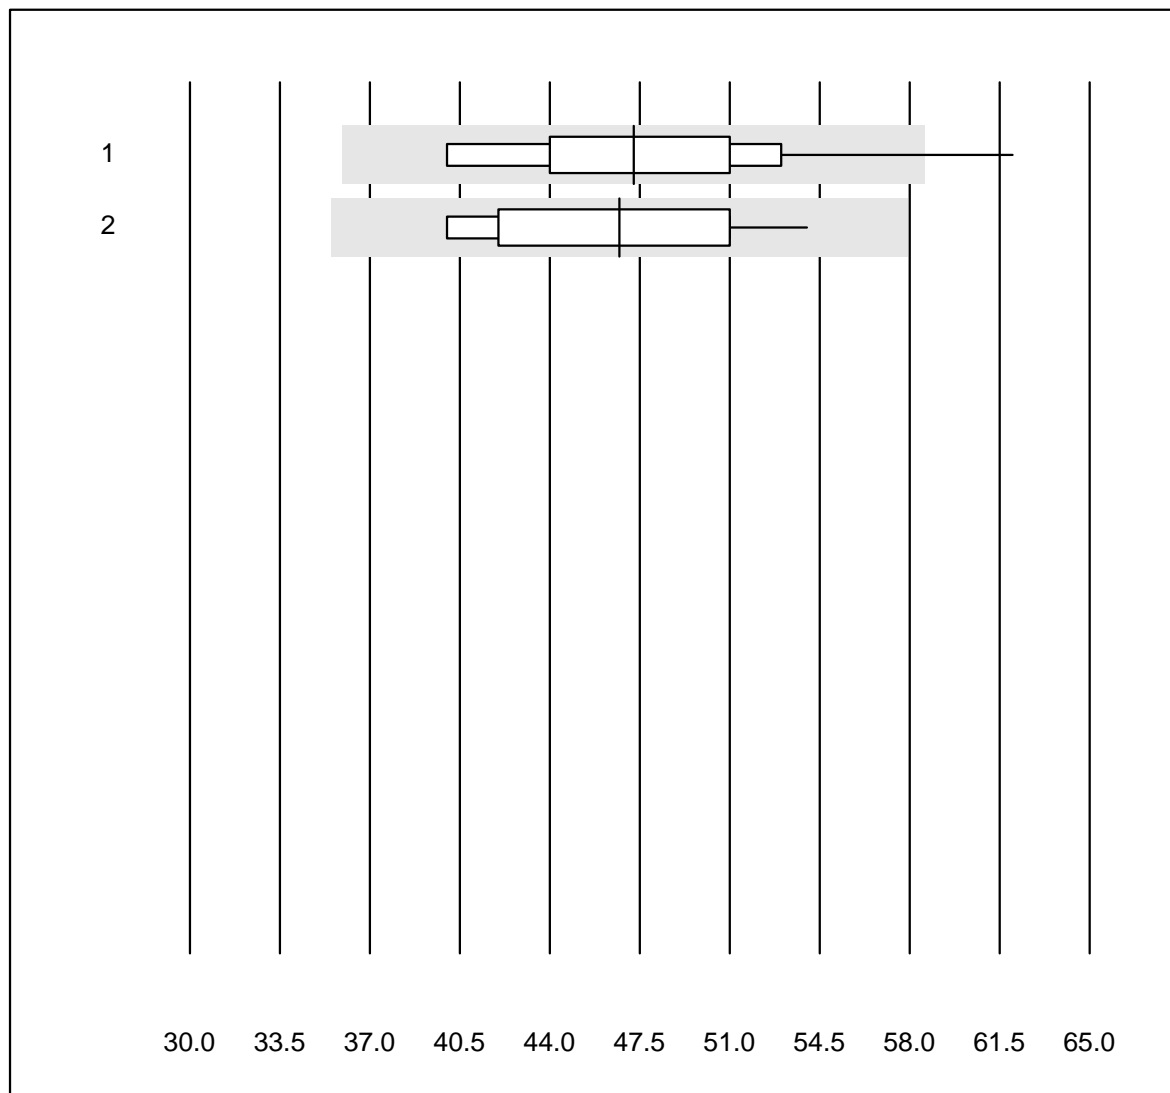


QUALAB Toleranz : 24 %

Troponine T CR (ng/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas h 232	1165	99.4	0.1	0.5	47.25	9.5	e
2	Cardiac Reader	13	100.0	0.0	0.0	46.69	10.7	e*

D-Dimères CR

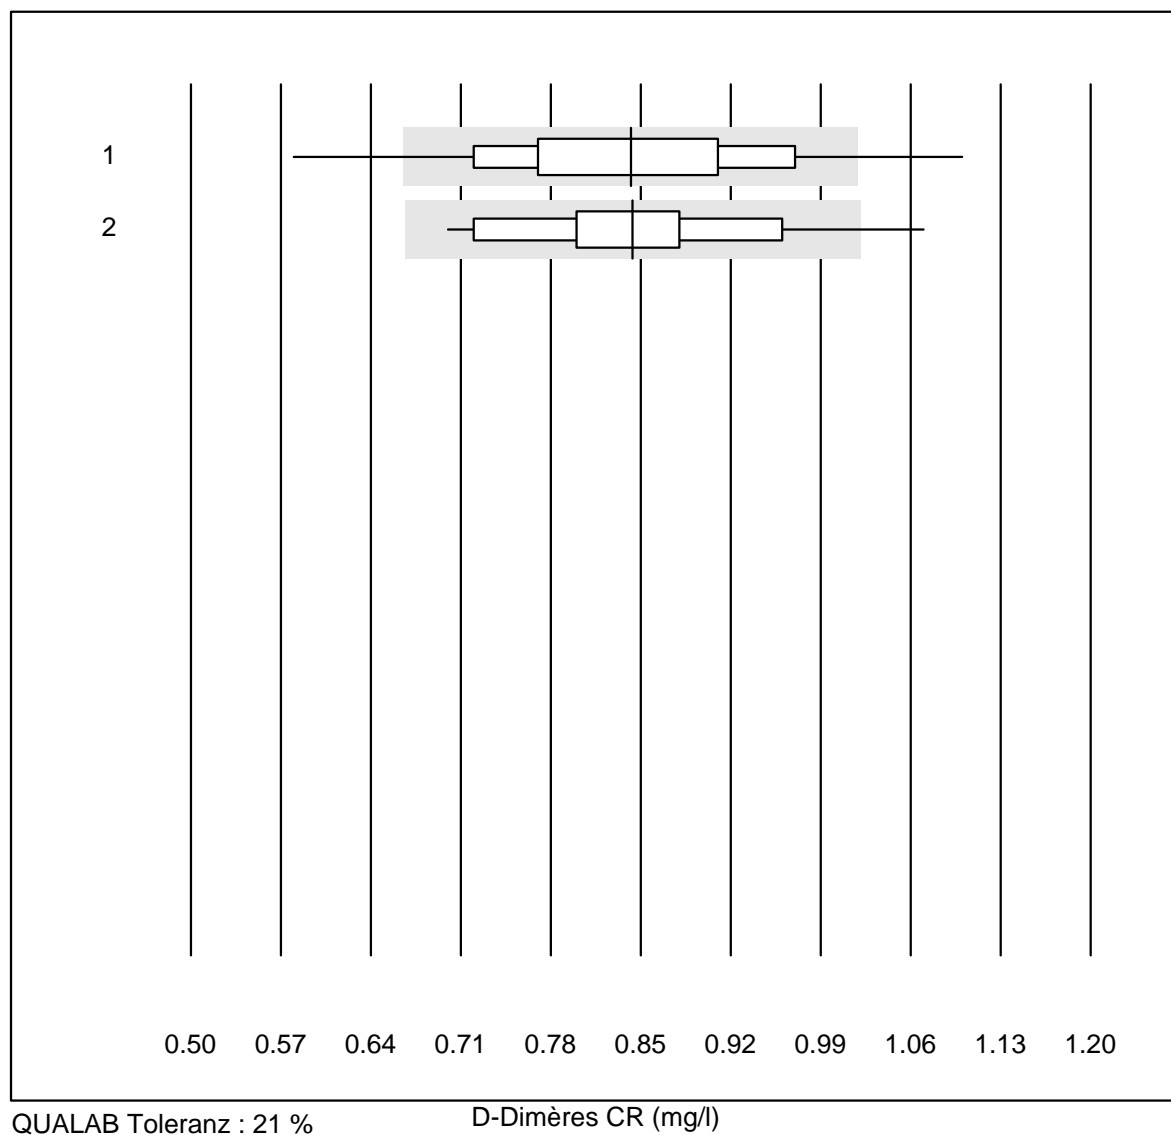


QUALAB Toleranz : 21 %

D-Dimères CR (mg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas h 232	1154	90.7	6.6	2.7	0.84	11.4	e
2	Cardiac Reader	13	92.3	7.7	0.0	0.84	12.0	e*

CKMB- K8

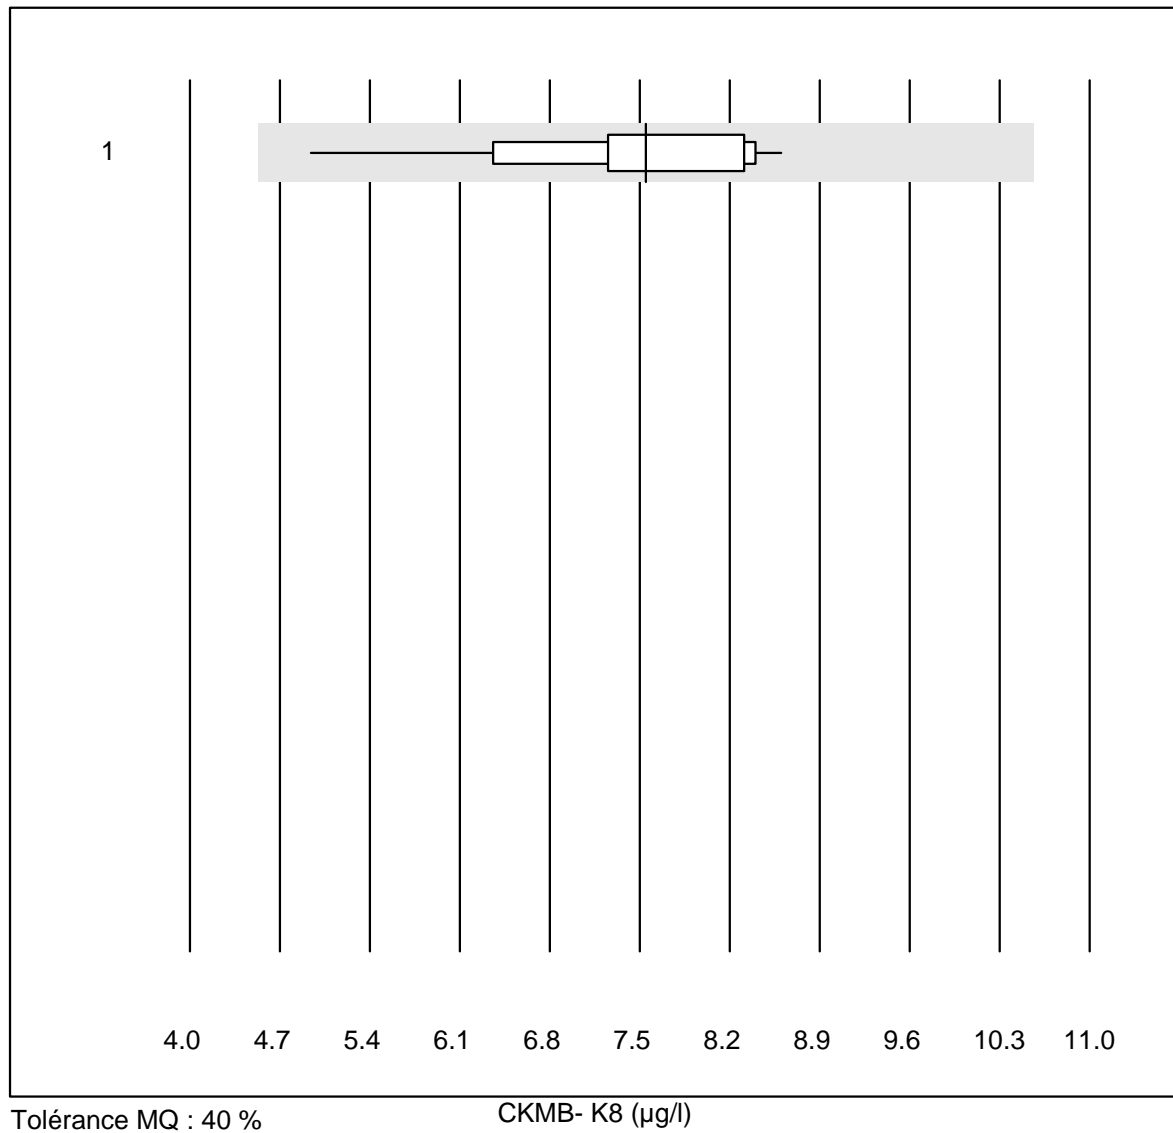

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas h 232	14	100.0	0.0	0.0	7.5	13.3	e

NT-proBNP CR




QUALAB Toleranz : 27 %

NT-proBNP CR (ng/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas h 232	717	96.6	2.4	1.0	254	11.2	e
2	Cardiac Reader	5	100.0	0.0	0.0	249	4.7	e

PCO2 CCA

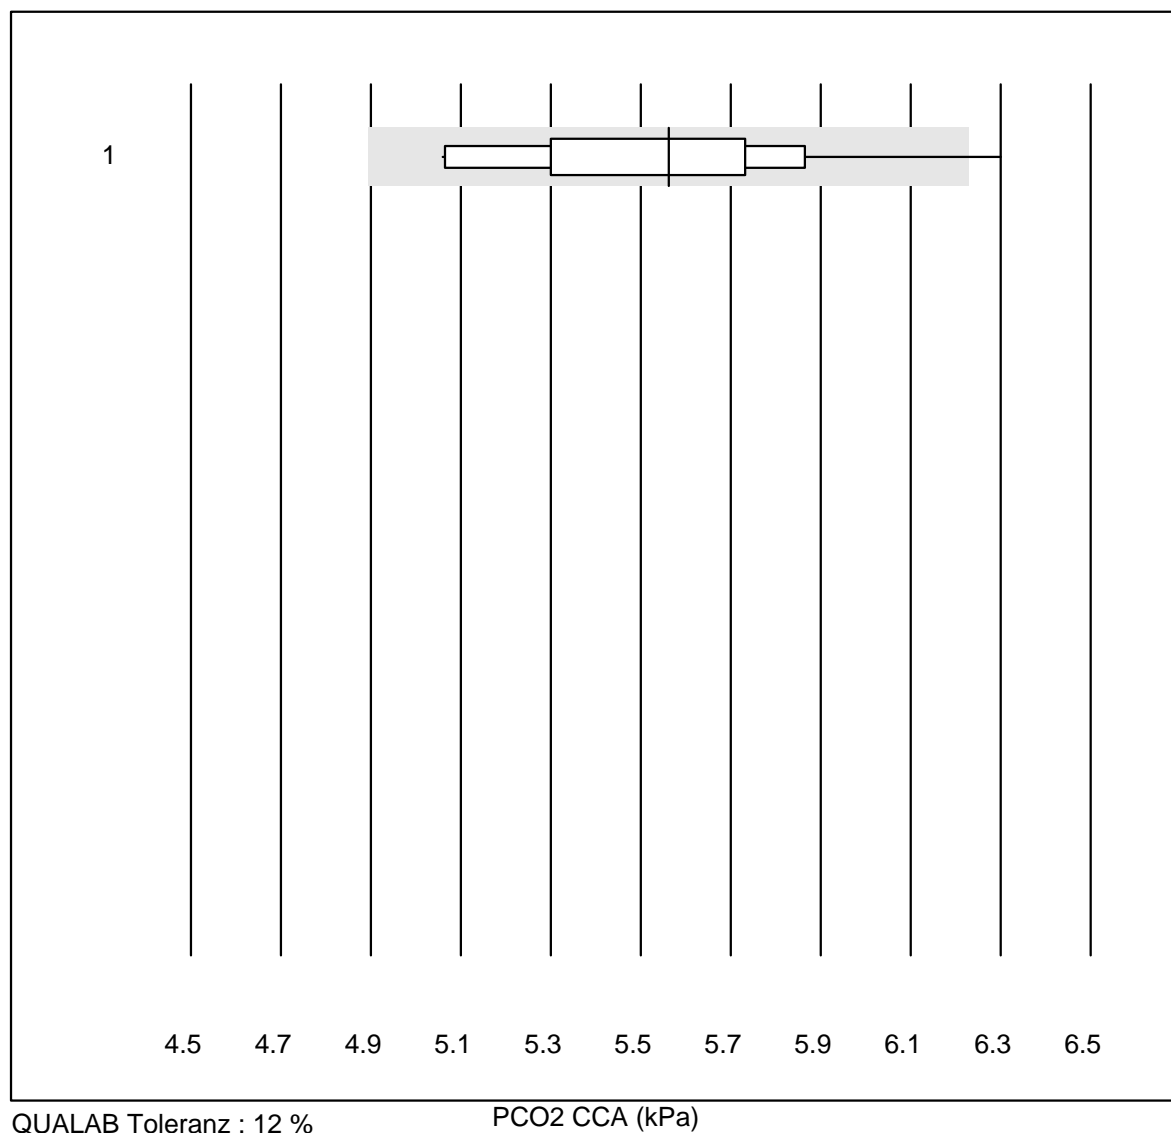

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 OPTI CCA	13	92.3	7.7	0.0	5.56	6.3	e*

PO2 CCA

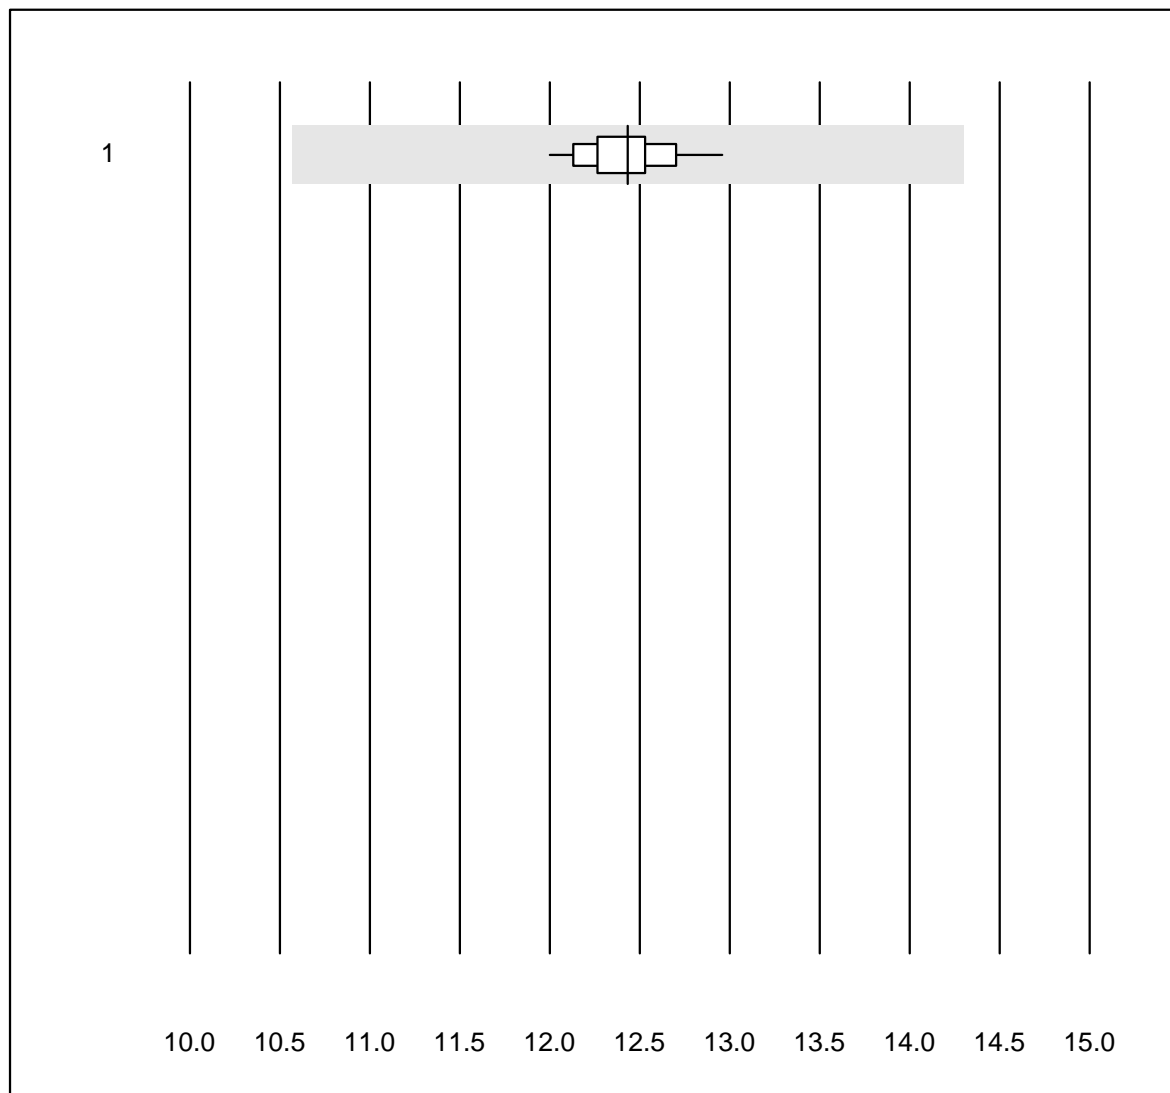


QUALAB Toleranz : 15 %

PO2 CCA (kPa)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 OPTI CCA	13	92.3	0.0	7.7	12.43	2.1	e

pH CCA

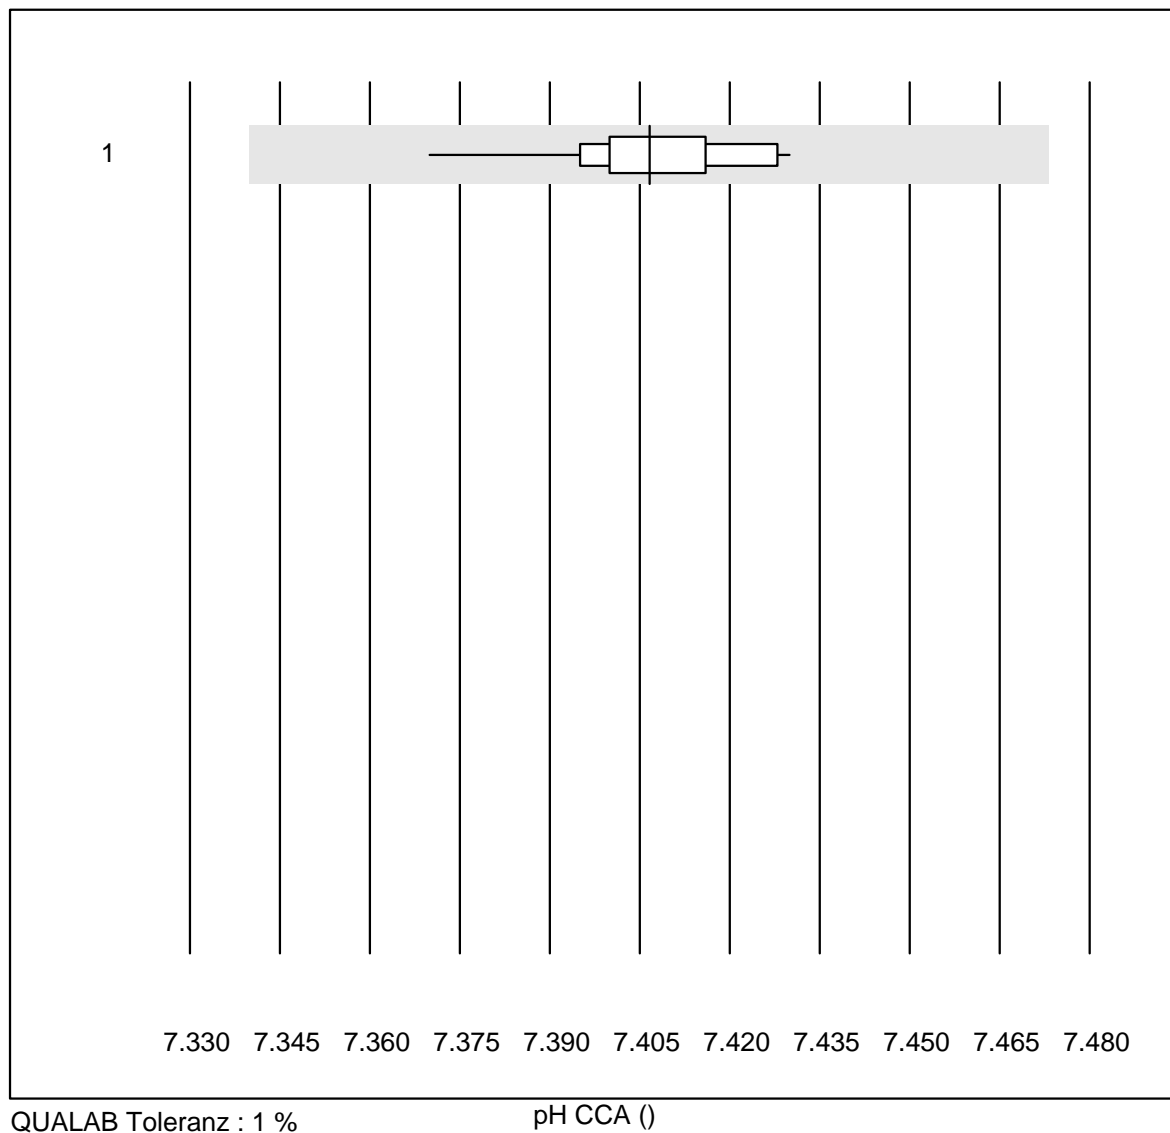

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 OPTI CCA	12	100.0	0.0	0.0	7.41	0.2	e

Potassium CCA

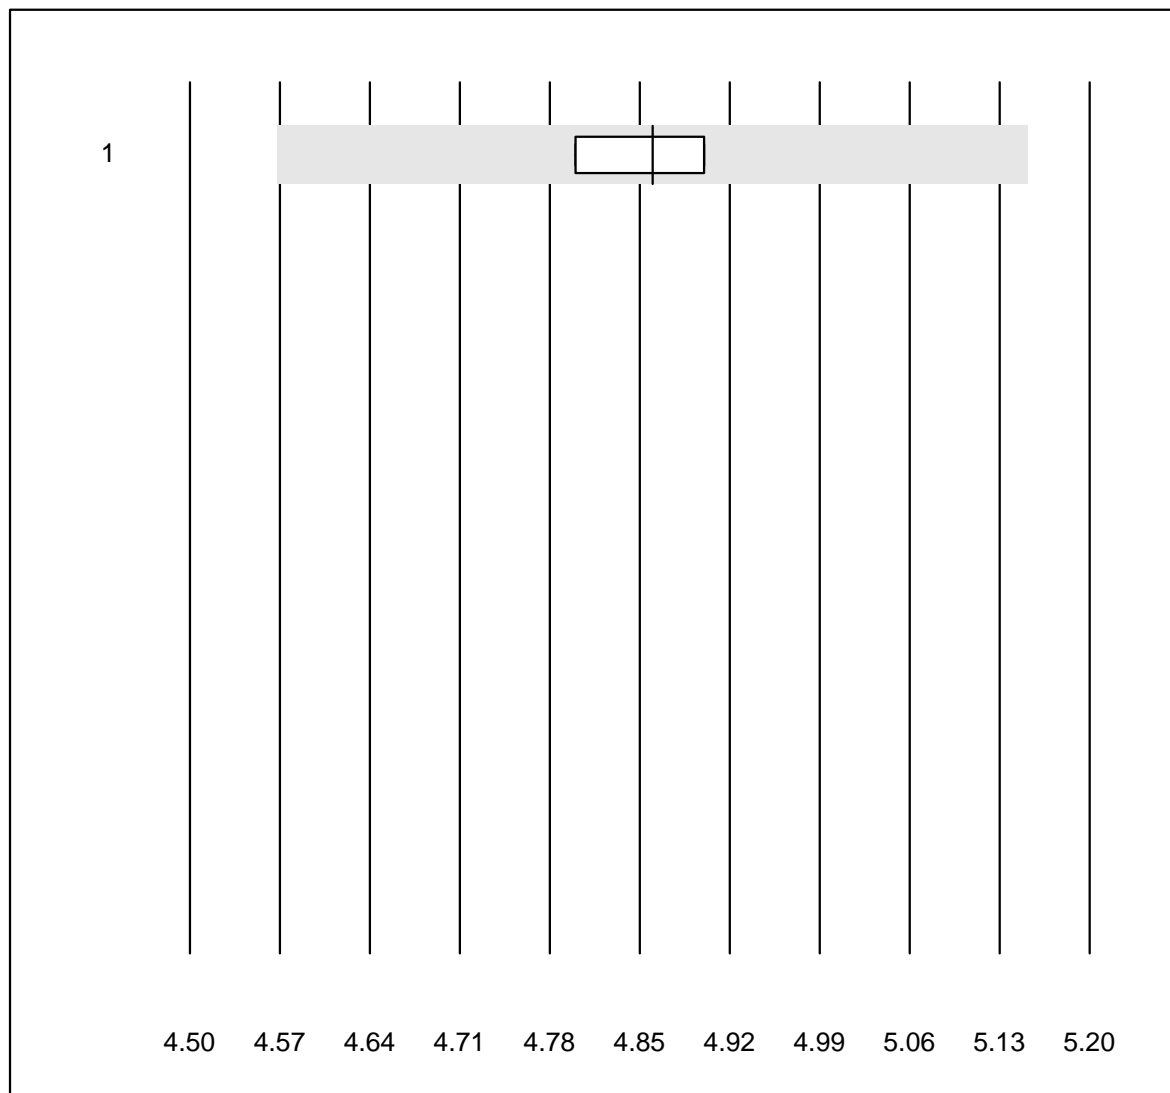


QUALAB Toleranz : 6 %

Potassium CCA (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	OPTI CCA	4	100.0	0.0	0.0	4.9	1.1	e

Ferritine

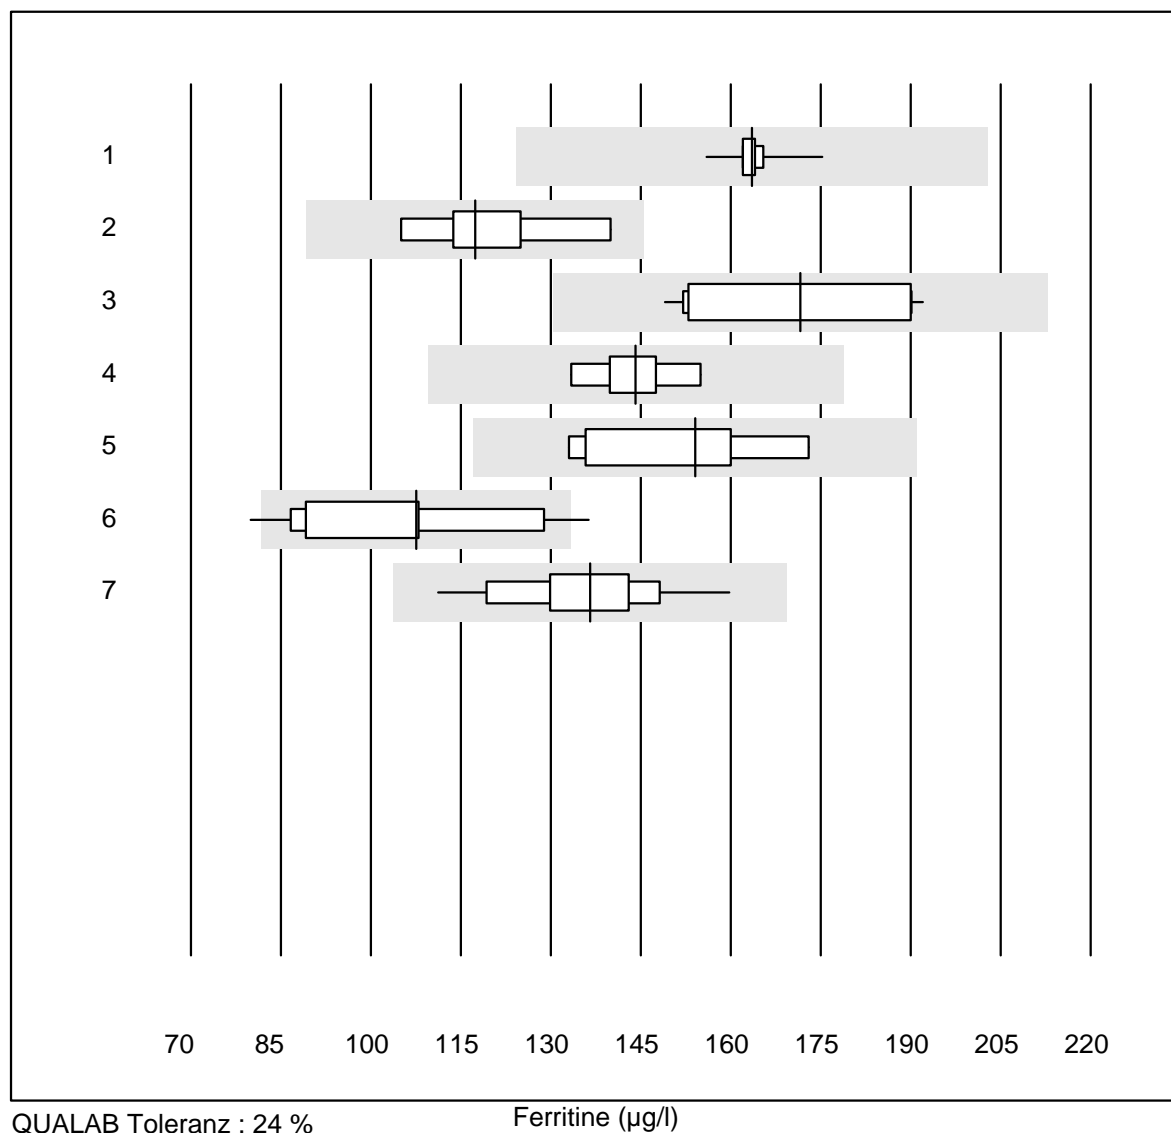


QUALAB Toleranz : 24 %

Ferritine (µg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Beckman	11	100.0	0.0	0.0	163.49	2.8	e
2	toutes les méthodes	6	83.3	0.0	16.7	117.39	10.8	e*
3	Cobas E / Elecsys	11	100.0	0.0	0.0	171.62	10.2	e*
4	Architect	8	100.0	0.0	0.0	144.15	5.1	e
5	Mini Vidas	8	100.0	0.0	0.0	154.07	9.4	e*
6	AFIAS	42	83.4	7.1	9.5	107.50	14.6	a
7	Eurolyser	18	100.0	0.0	0.0	136.53	8.2	e

Vitamine B12

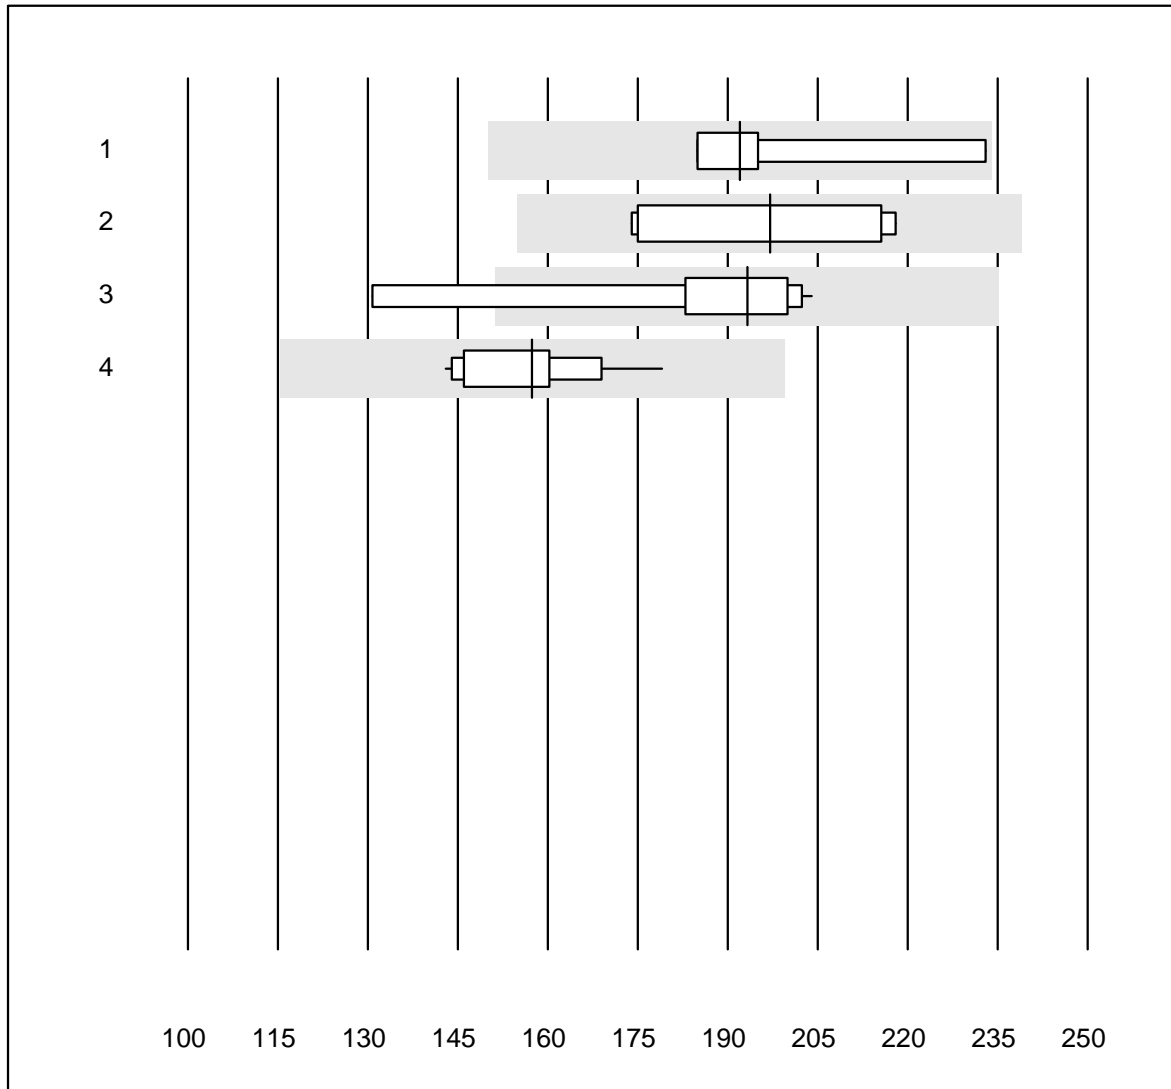


QUALAB Toleranz : 21 %
(< 200.00: +/- 42.00 pmol/l)

Vitamine B12 (pmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	192.00	11.0	e*
2 ADVIA Centaur XP/CP	5	100.0	0.0	0.0	197.00	10.8	e*
3 Cobas E / Elecsys	10	90.0	10.0	0.0	193.25	11.6	e*
4 Architect	12	100.0	0.0	0.0	157.40	7.1	e

Folate

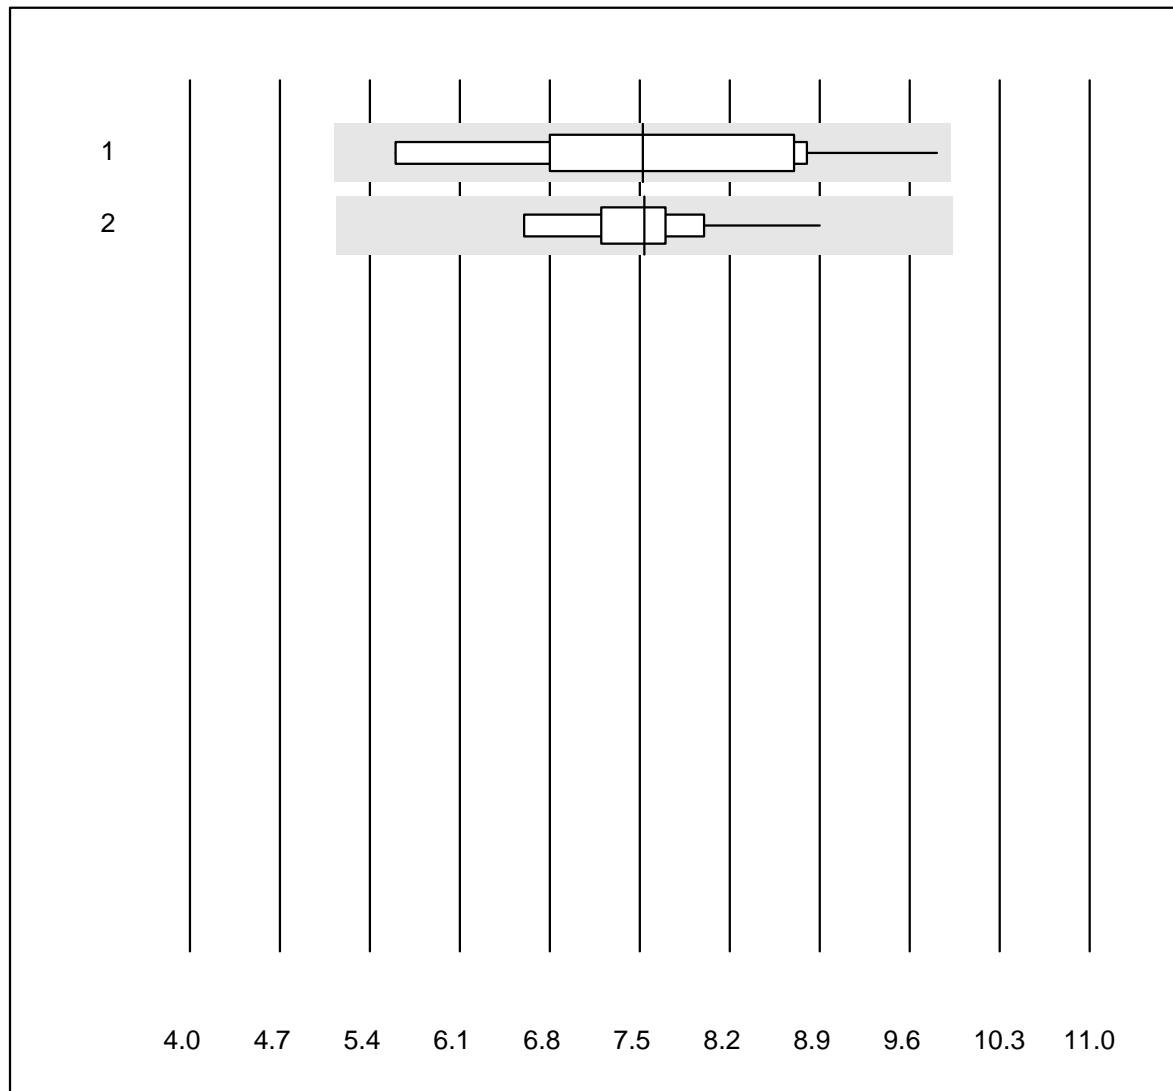


QUALAB Toleranz : 24 %
 (< 10.00: +/- 2.40 nmol/l)

Folate (nmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	10	100.0	0.0	0.0	7.52	17.5	e*
2	Architect	10	100.0	0.0	0.0	7.54	8.2	e

Holotranscobalamine

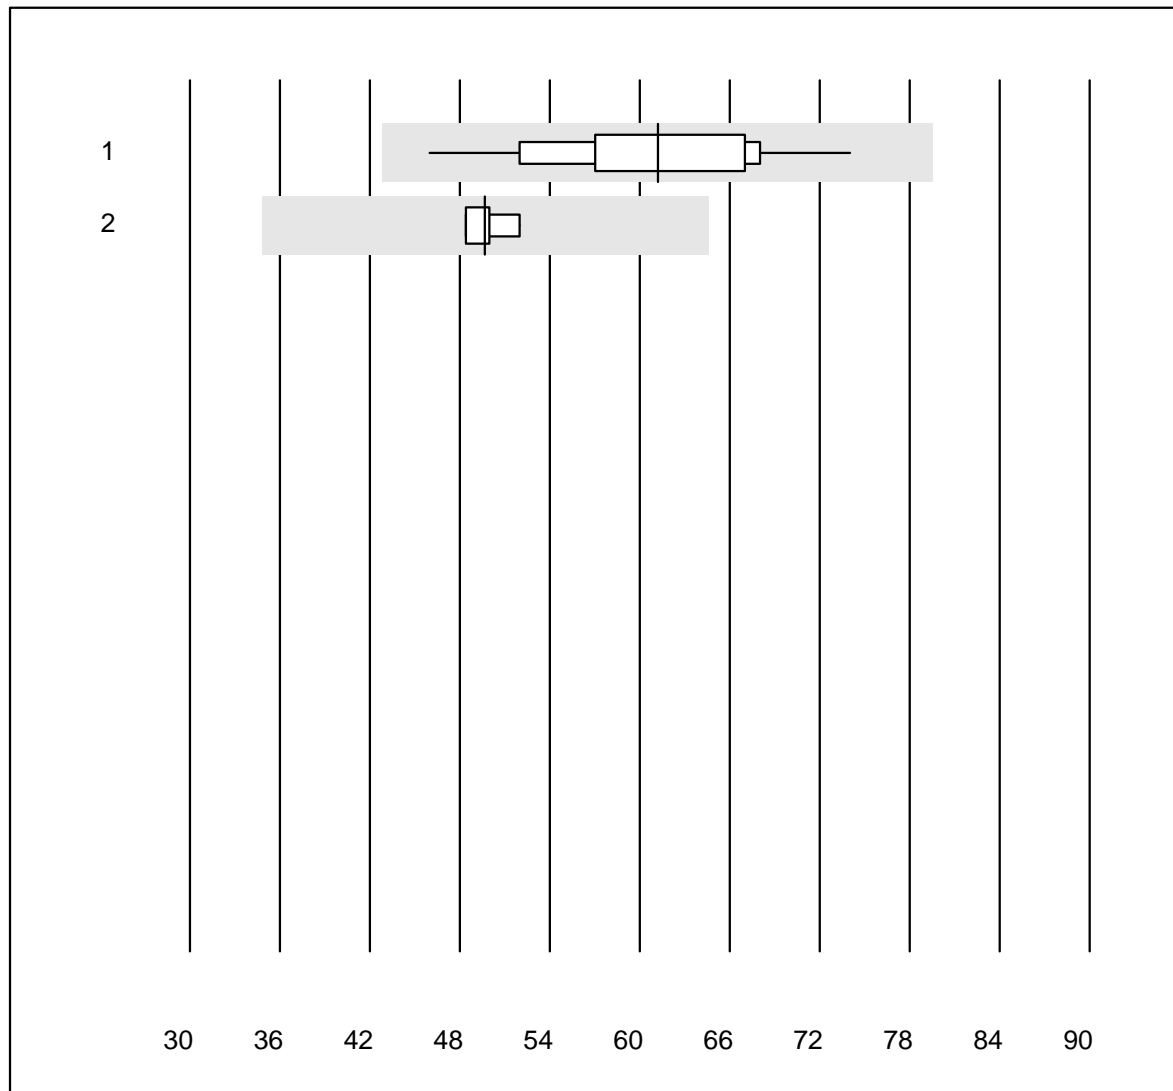


Tolérance MQ : 30 %

Holotranscobalamine (pmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Architect	13	100.0	0.0	0.0	61.2	12.5	e
2 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	49.7	3.1	e

Bilirubin totale Neo

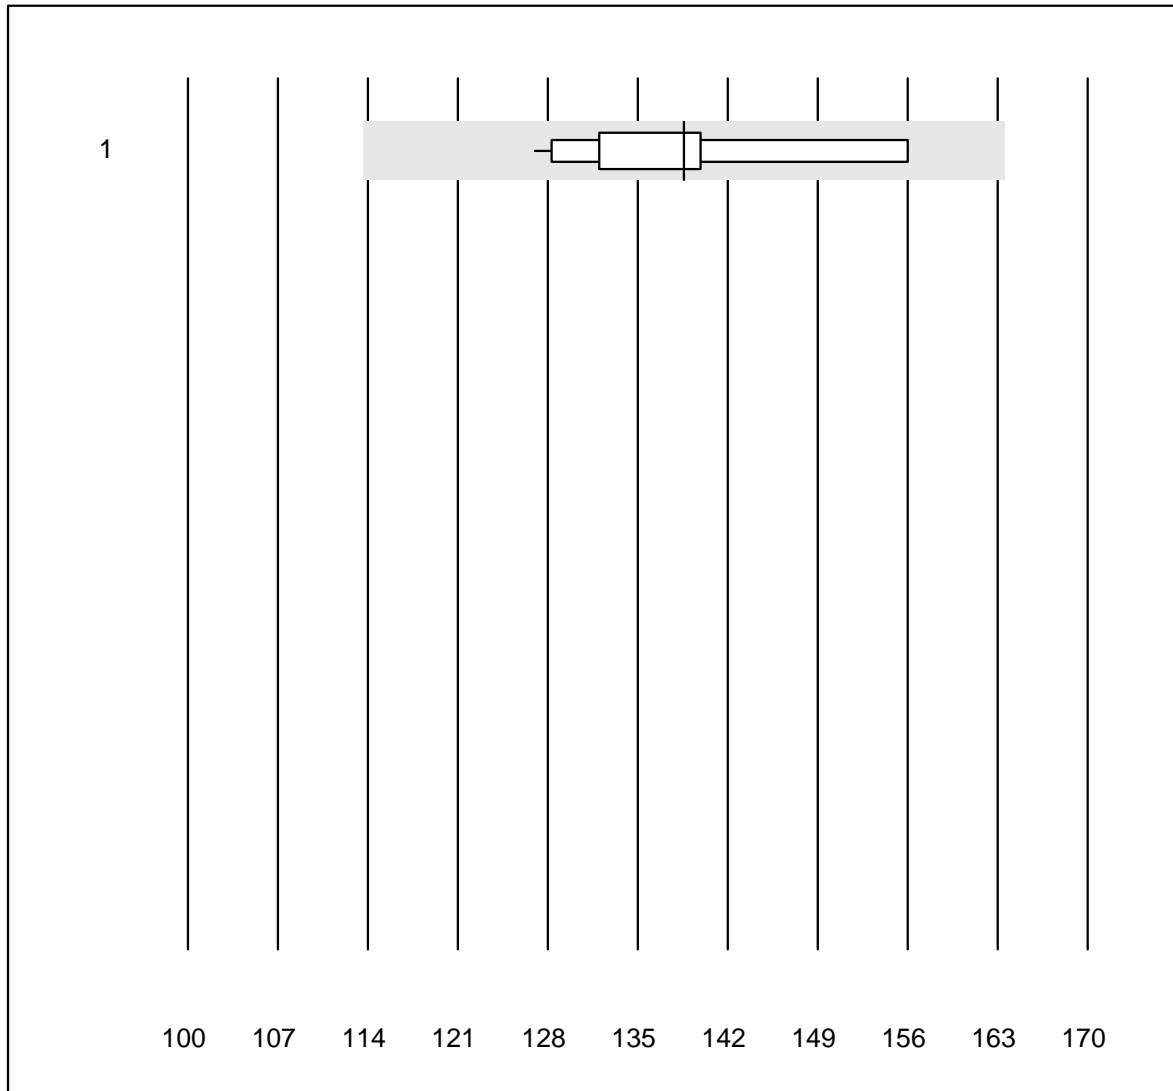


QUALAB Toleranz : 18 %

Bilirubin totale Neo ($\mu\text{mol/l}$)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	17	100.0	0.0	0.0	139	6.8	e

Bilirubin directe

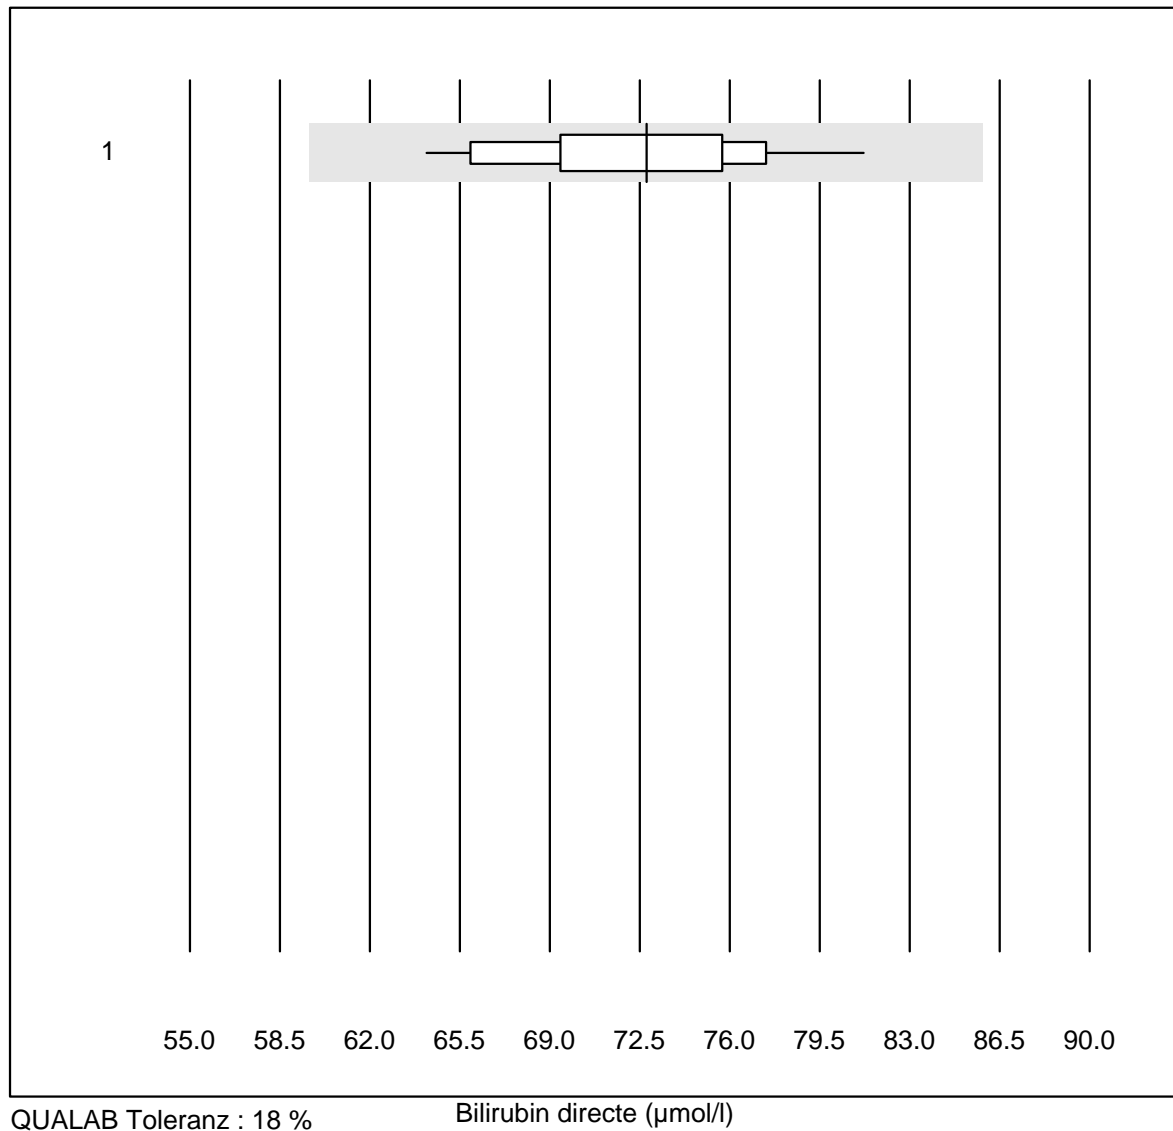

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	19	100.0	0.0	0.0	73	6.1	e

Bilirubin néonatale

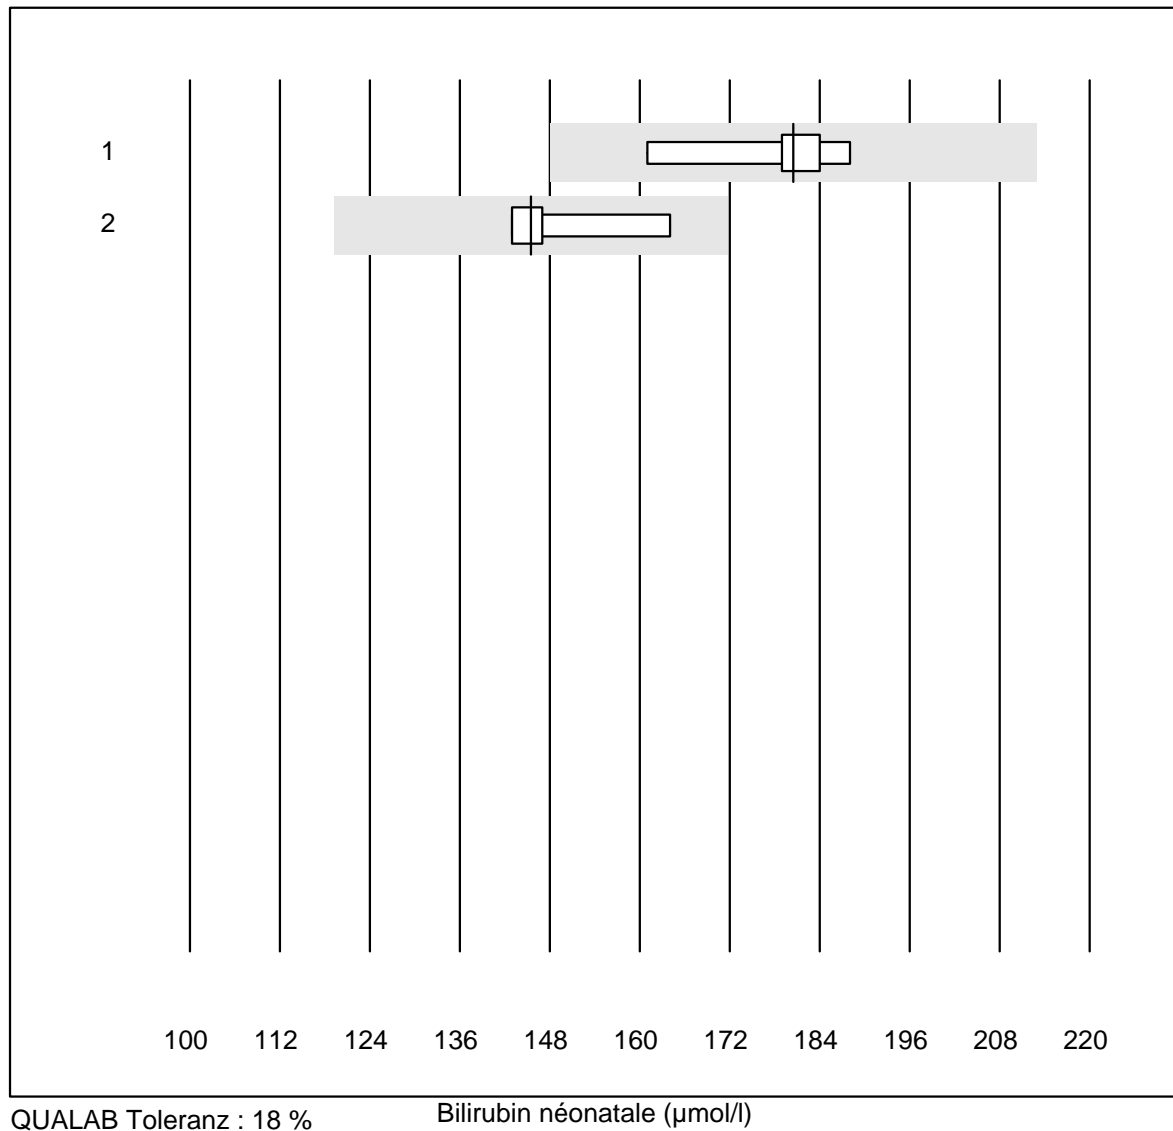


QUALAB Toleranz : 18 %

Bilirubin néonatale (µmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	8	100.0	0.0	0.0	181	4.5	e
2 ABL700/800	4	100.0	0.0	0.0	146	6.6	e*

PSA

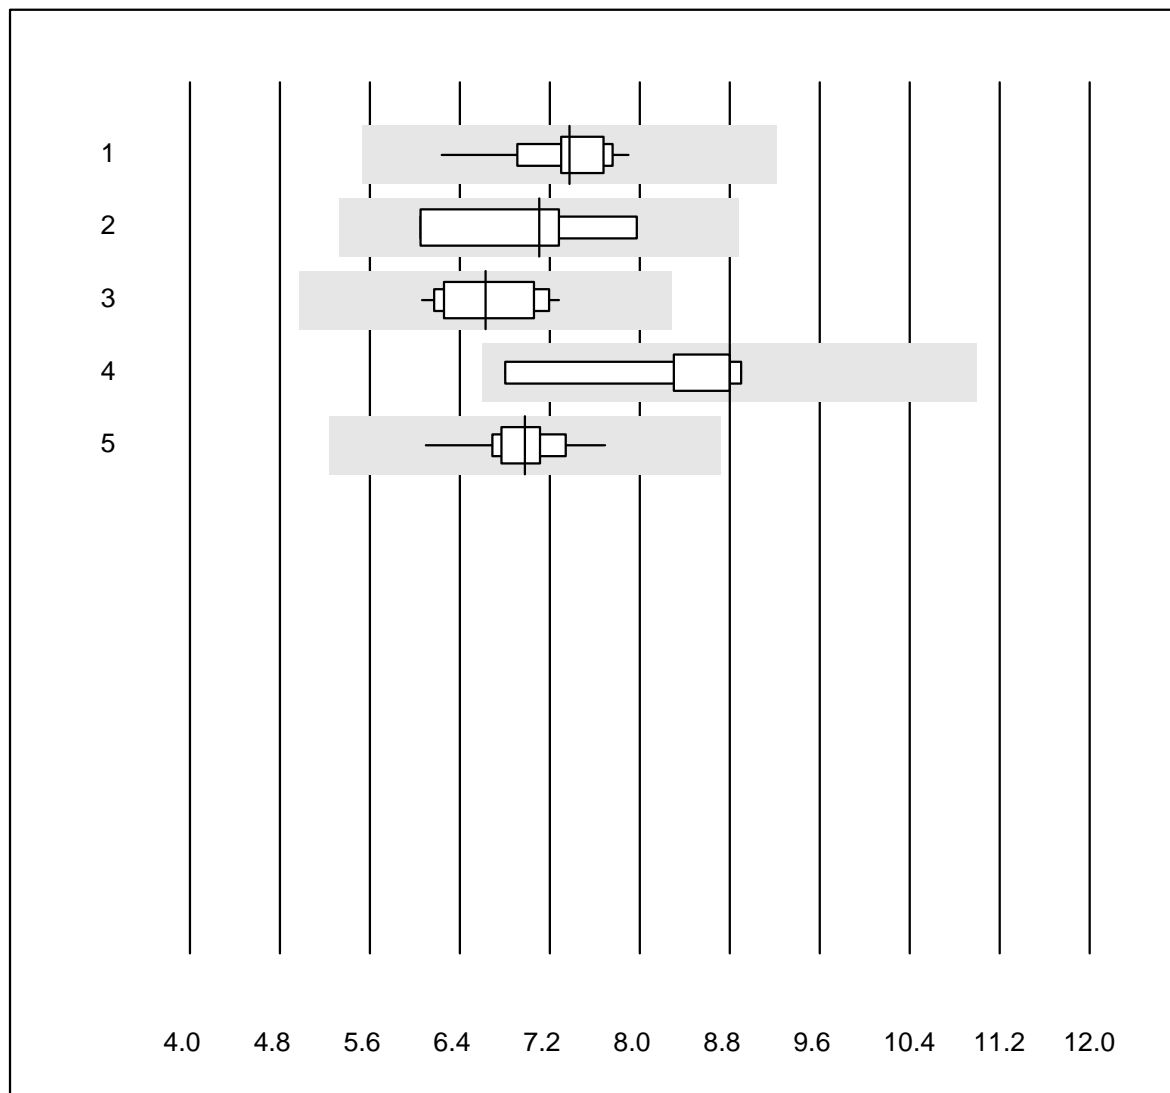


QUALAB Toleranz : 25 %

PSA (µg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	11	100.0	0.0	0.0	7.37	6.2	e
2	VIDAS	4	100.0	0.0	0.0	7.11	11.3	e*
3	Architect	11	100.0	0.0	0.0	6.63	6.4	e
4	Qualigen	5	100.0	0.0	0.0	8.80	10.6	e*
5	AFIAS	32	96.9	0.0	3.1	6.98	4.4	a

PSA frei

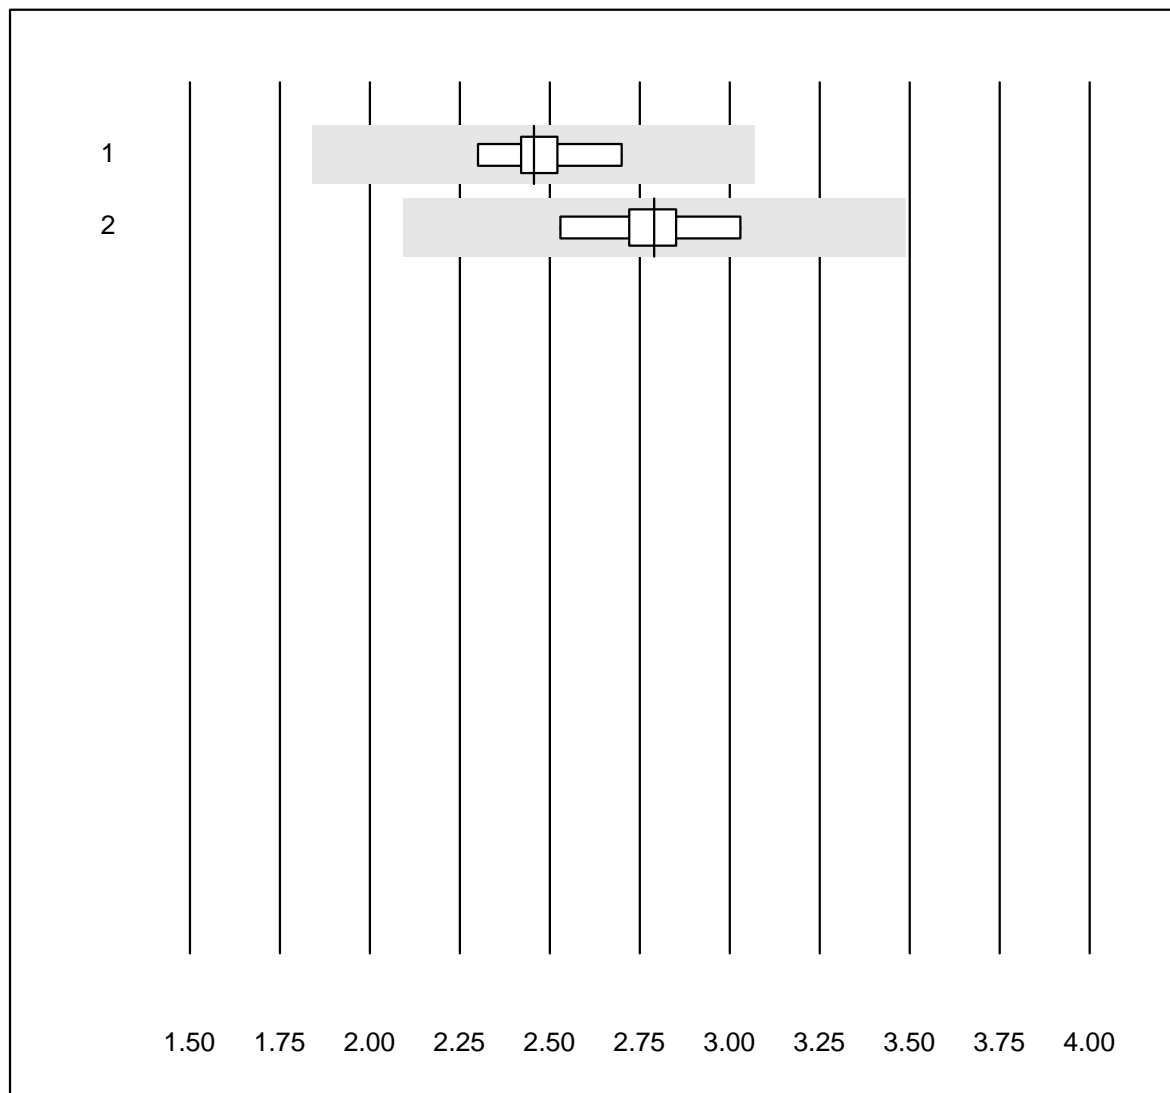


QUALAB Toleranz : 25 %

PSA frei (µg/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	6	100.0	0.0	0.0	2.46	5.3	e
2 Architect	9	100.0	0.0	0.0	2.79	5.5	e

CEA

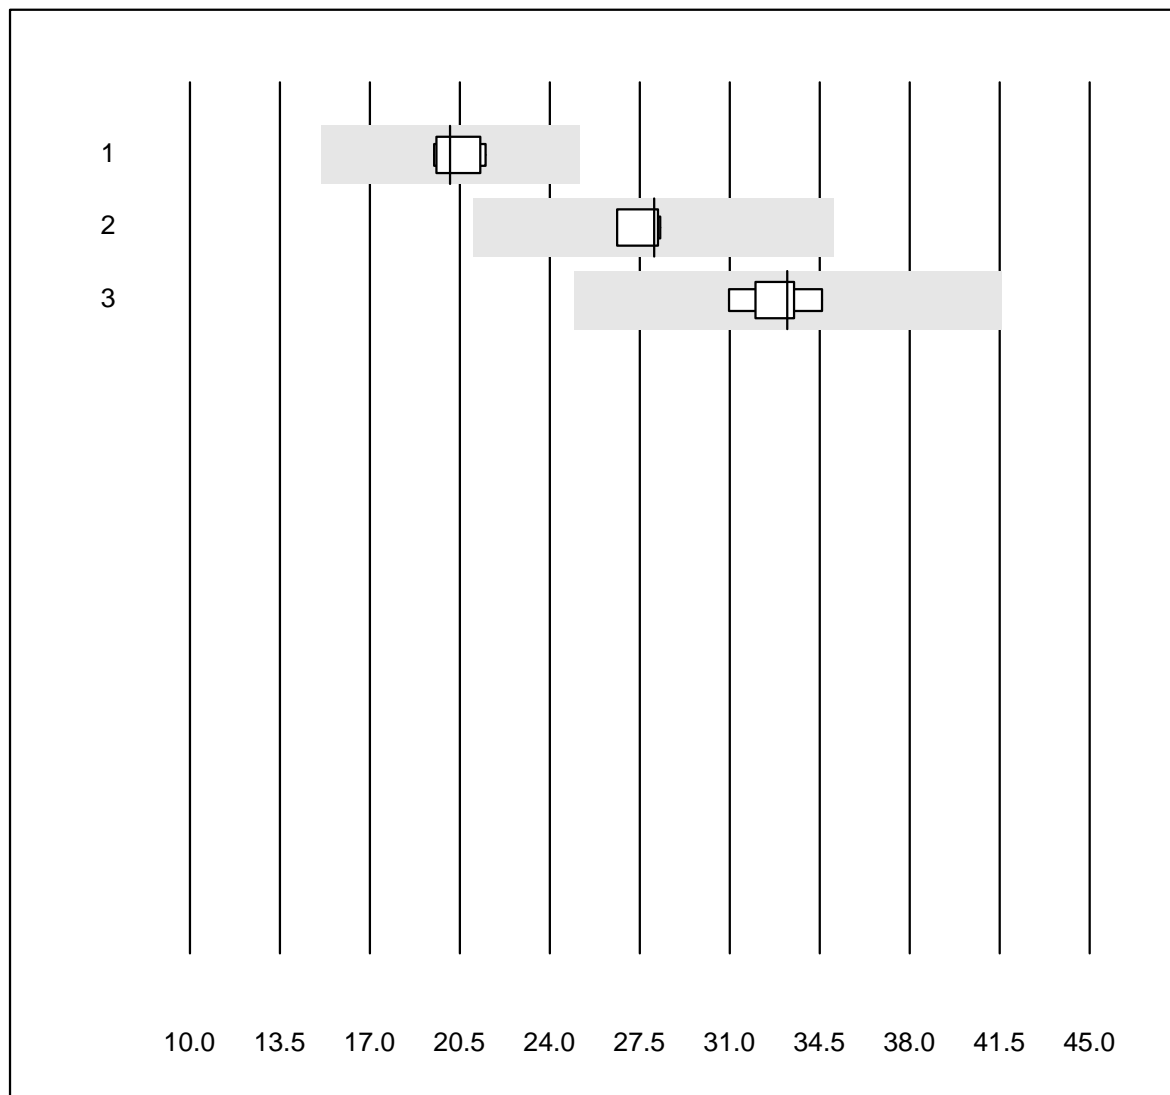


QUALAB Toleranz : 25 %

CEA (µg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	7	100.0	0.0	0.0	20.1	4.1	e
2	ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	28.1	2.8	e
3	Architect	8	100.0	0.0	0.0	33.2	3.6	e

CA 125

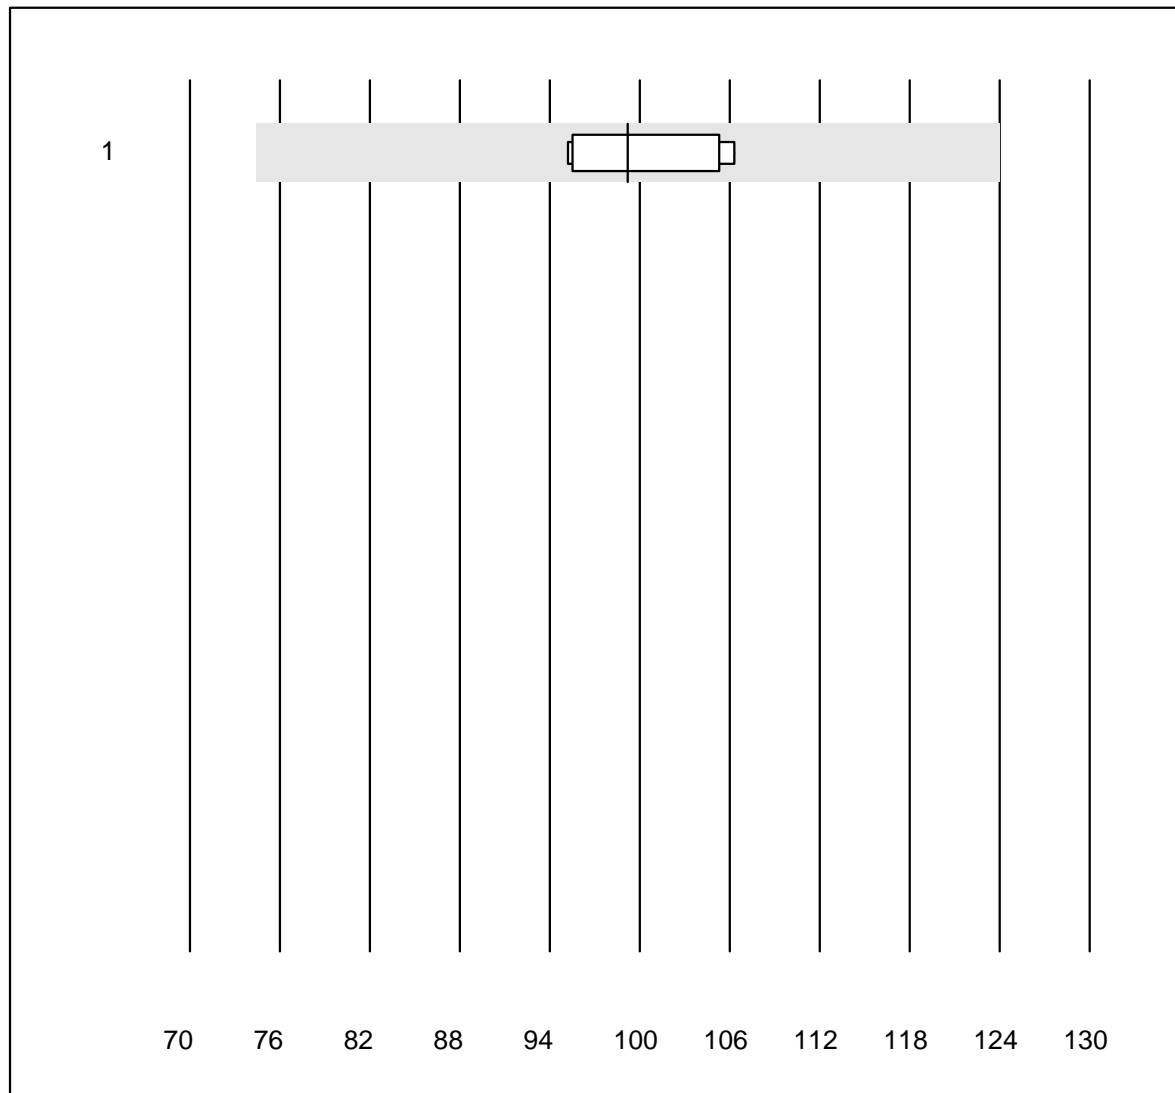


Tolérance MQ : 25 %

CA 125 (kIU/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Architect	6	100.0	0.0	0.0	99.2	4.7	e

CA 19-9

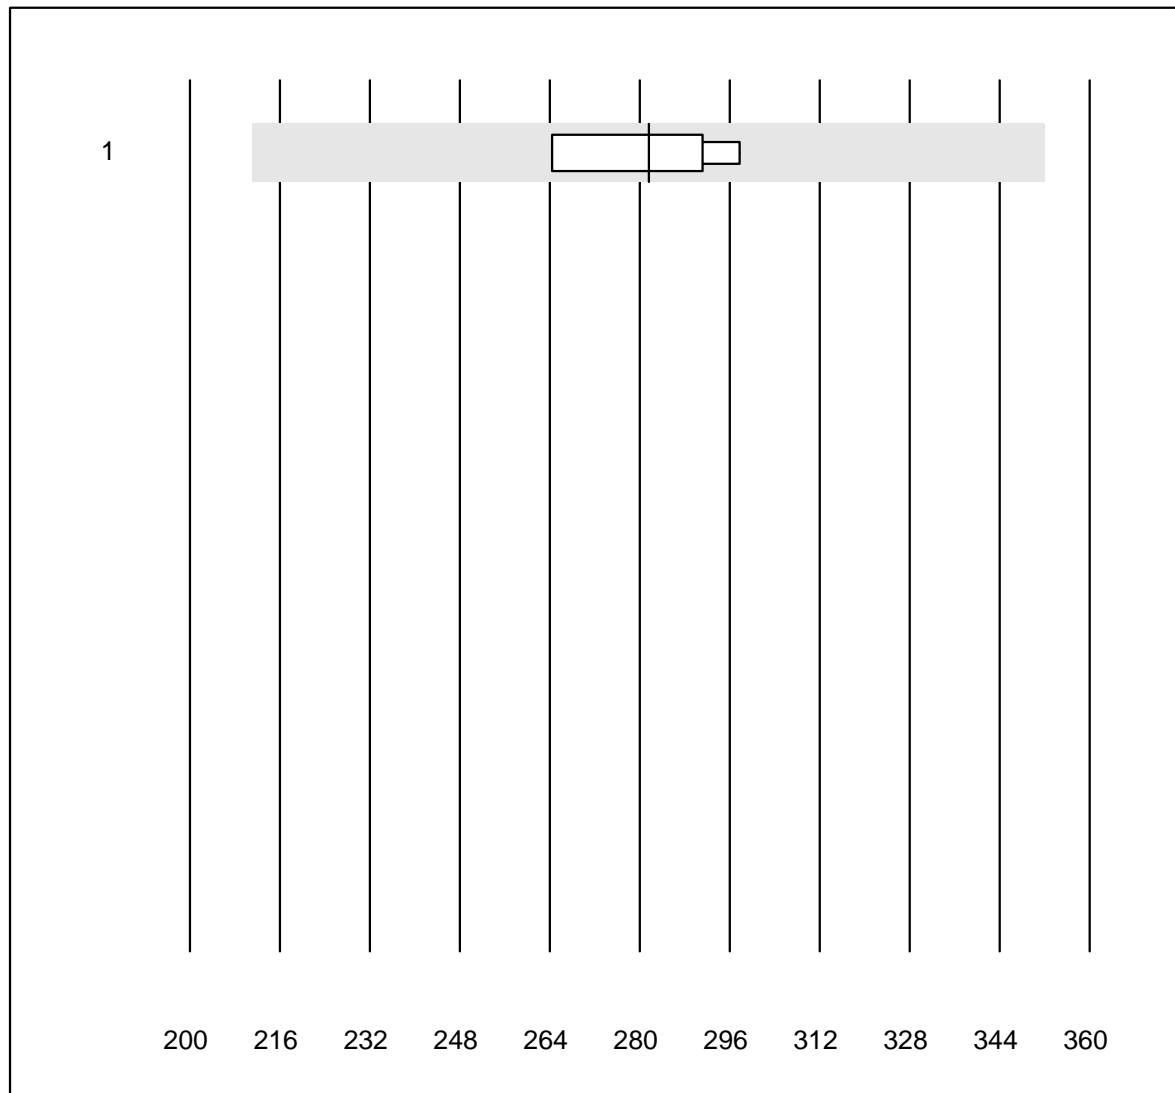


Tolérance MQ : 25 %

CA 19-9 (kIU/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Architect	4	100.0	0.0	0.0	281.6	5.6	e

CA 15-3

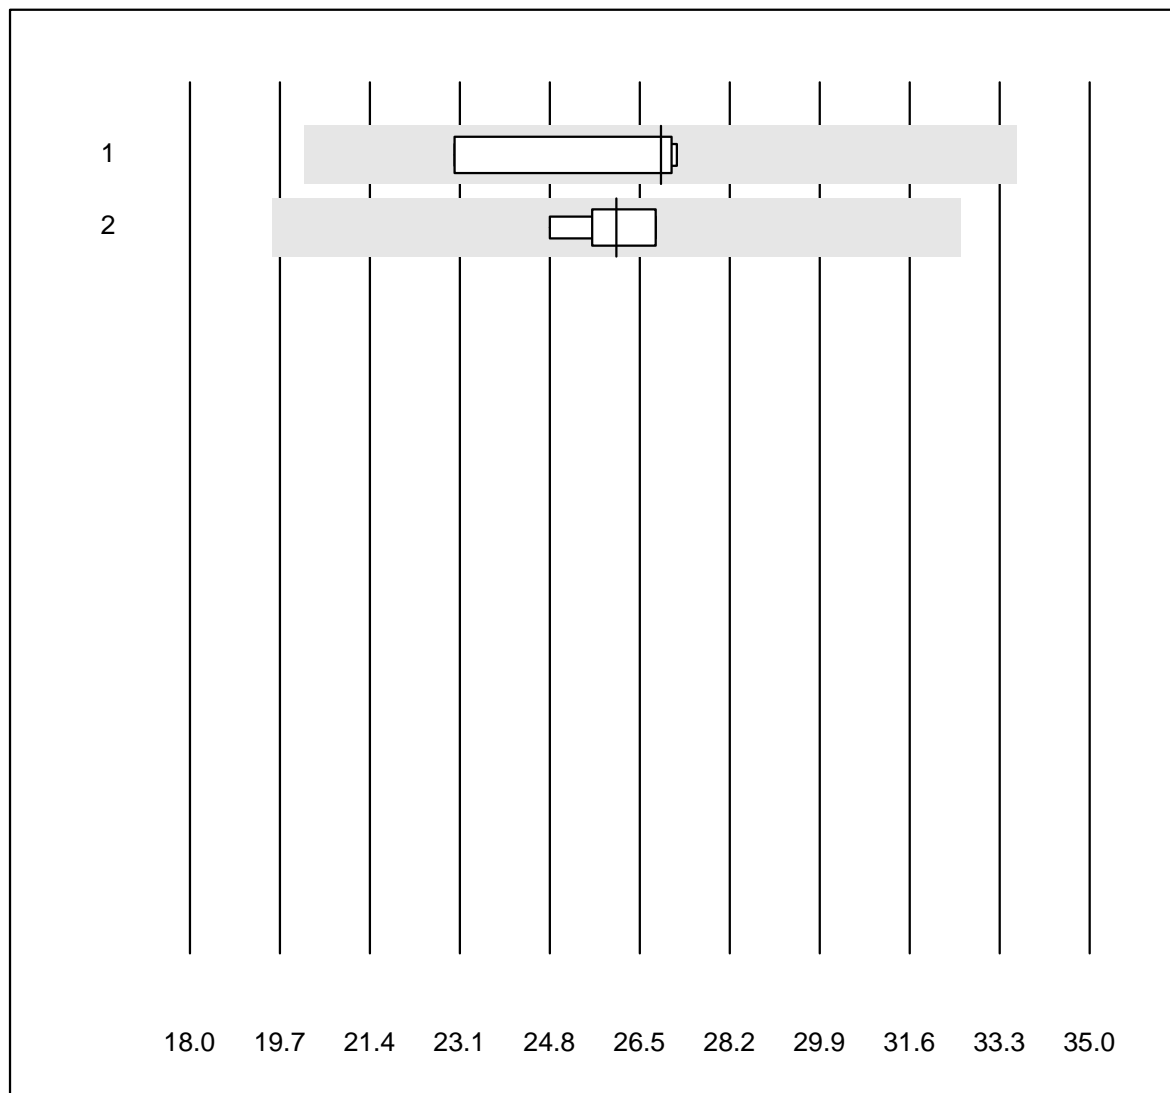


Tolérance MQ : 25 %

CA 15-3 (kIU/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	4	100.0	0.0	0.0	26.9	7.7	e*
2 Architect	6	100.0	0.0	0.0	26.1	2.9	e

AFP

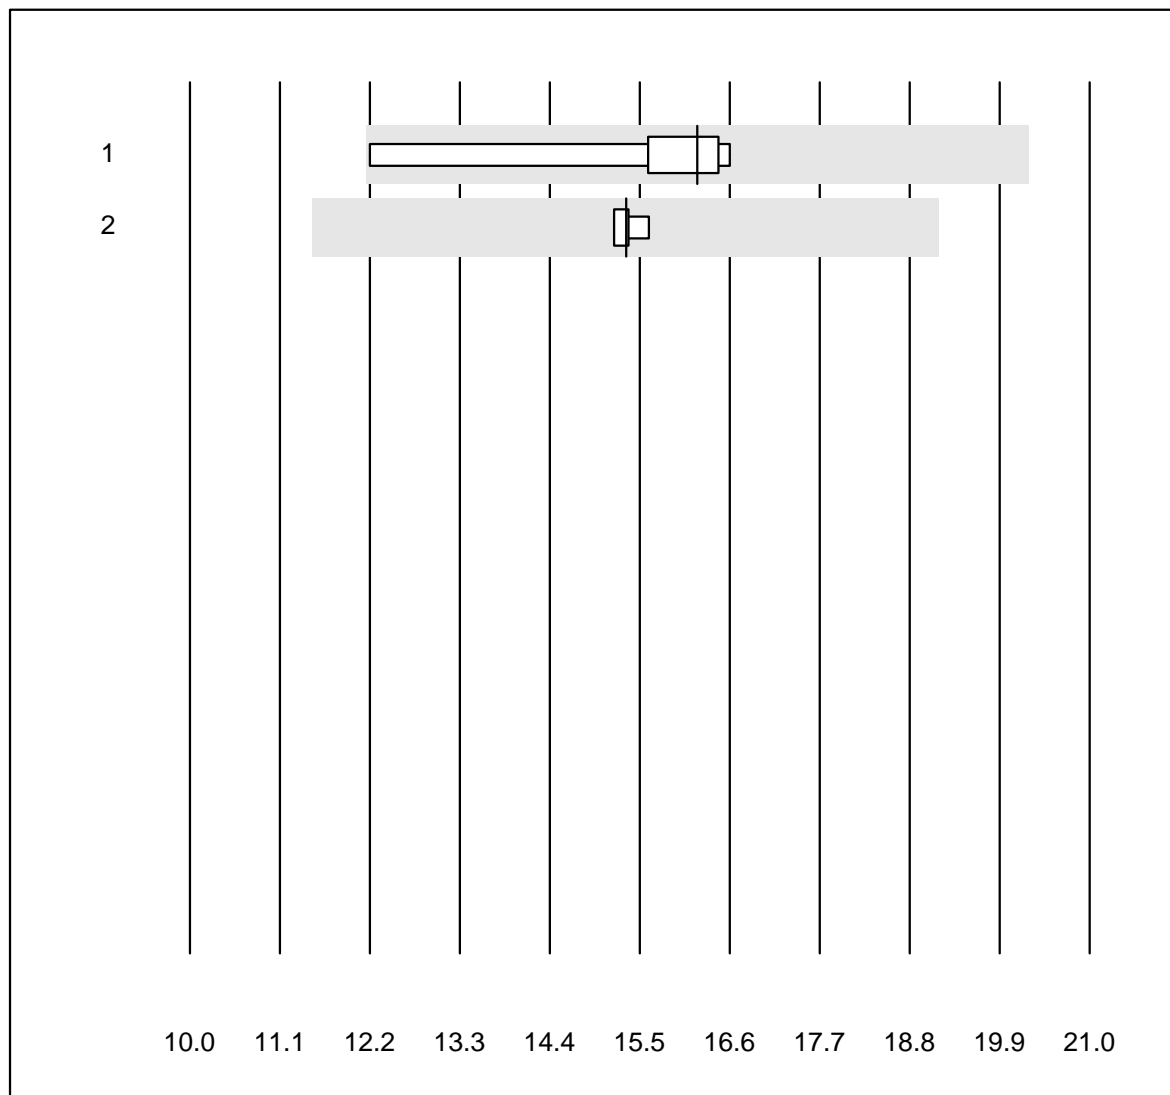


QUALAB Toleranz : 25 %

AFP (µg/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	5	100.0	0.0	0.0	16.2	11.9	e*
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	15.3	1.2	e

HCG qn

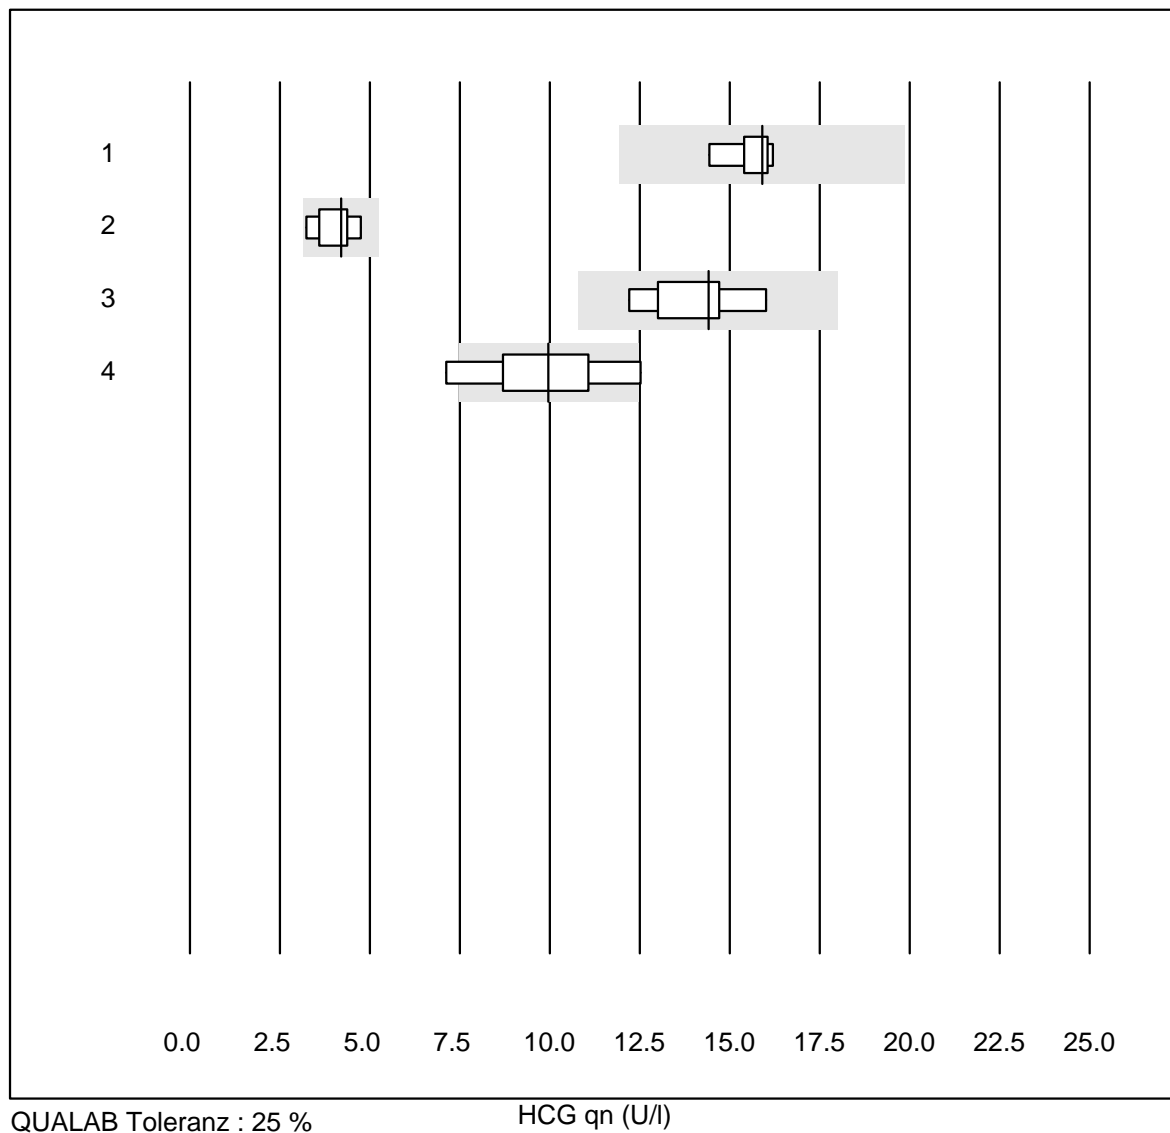

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	6	100.0	0.0	0.0	15.9	4.2	e
2 VIDAS	8	100.0	0.0	0.0	4.2	12.6	e*
3 Architect	8	100.0	0.0	0.0	14.4	8.4	e
4 AFIAS	8	75.0	25.0	0.0	10.0	16.9	e*

CK-MB

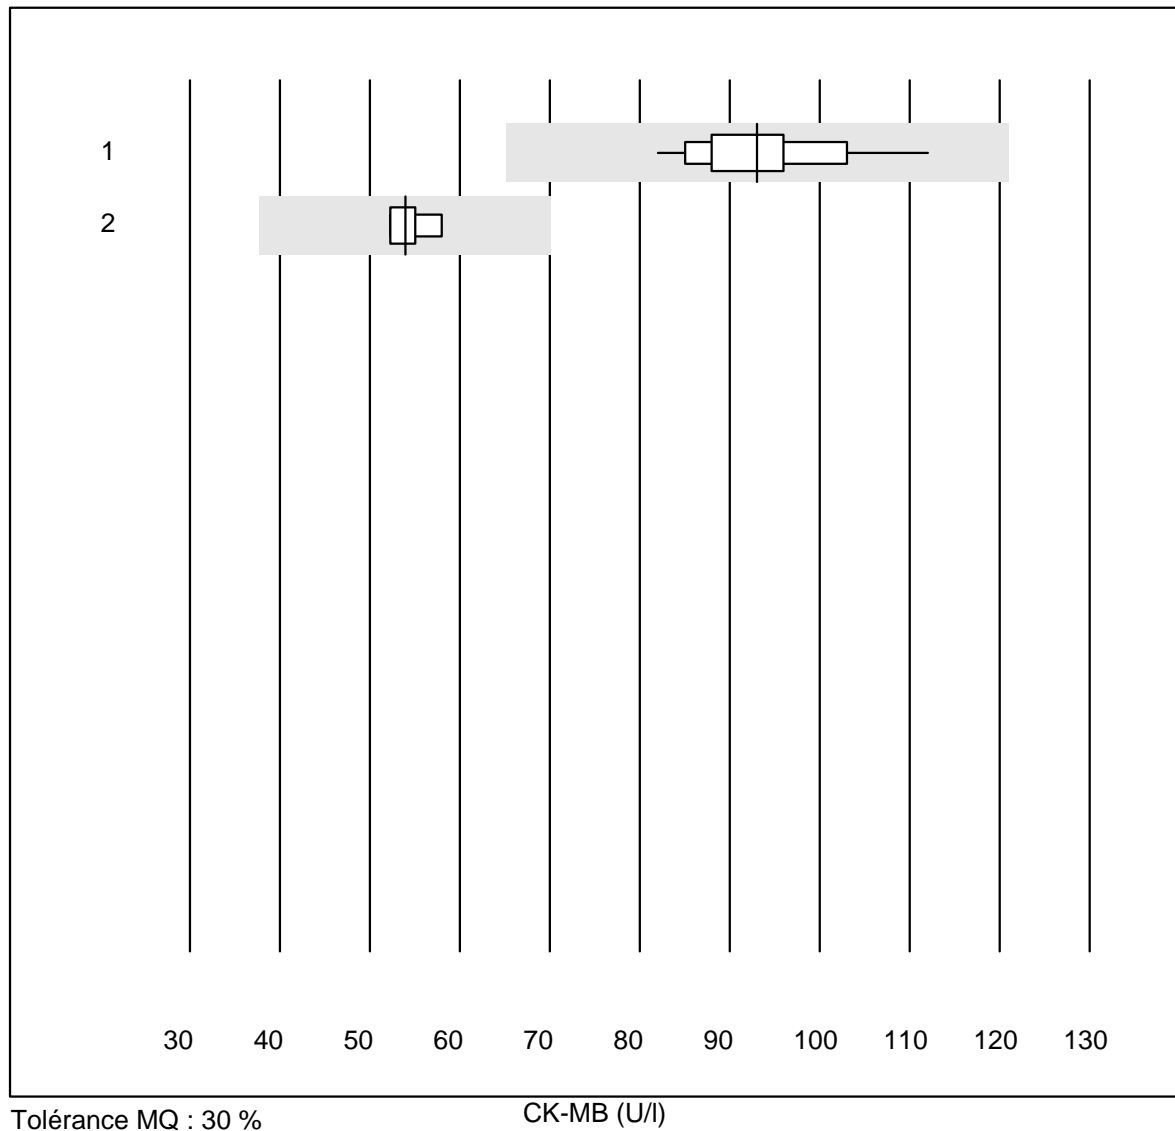


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Fuji Dri-Chem	34	100.0	0.0	0.0	93.0	7.8	e
2	Cobas/Roche	4	100.0	0.0	0.0	54.0	4.7	e

BNP



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Architect	5	100.0	0.0	0.0	2222.9	8.6	e*

Cholesterin PTS

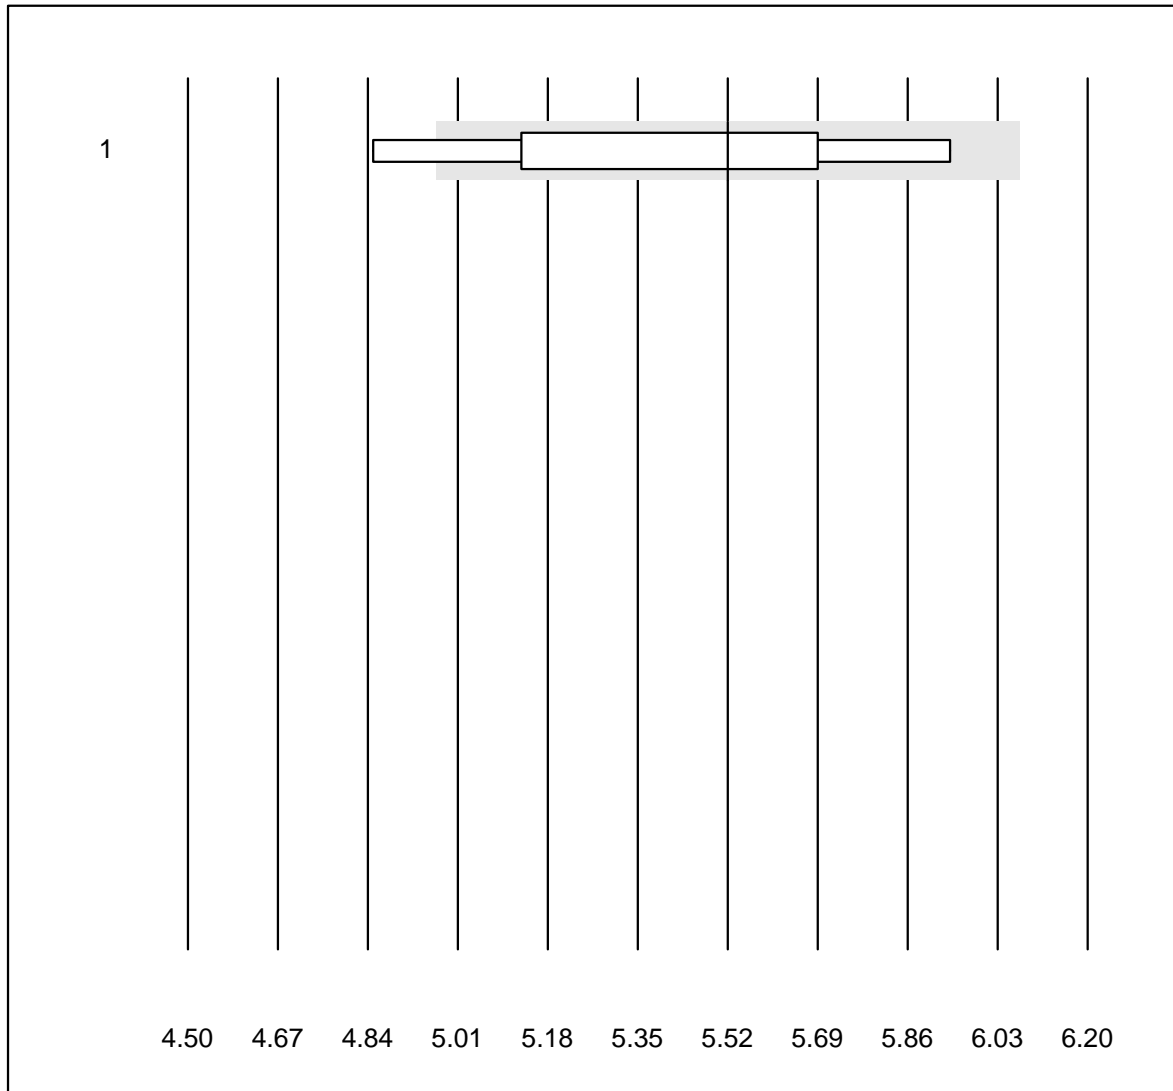


QUALAB Toleranz : 10 %

Cholesterin PTS (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 CardioChek	9	77.8	11.1	11.1	5.52	6.9	e*

Cholesterin HDL PTS

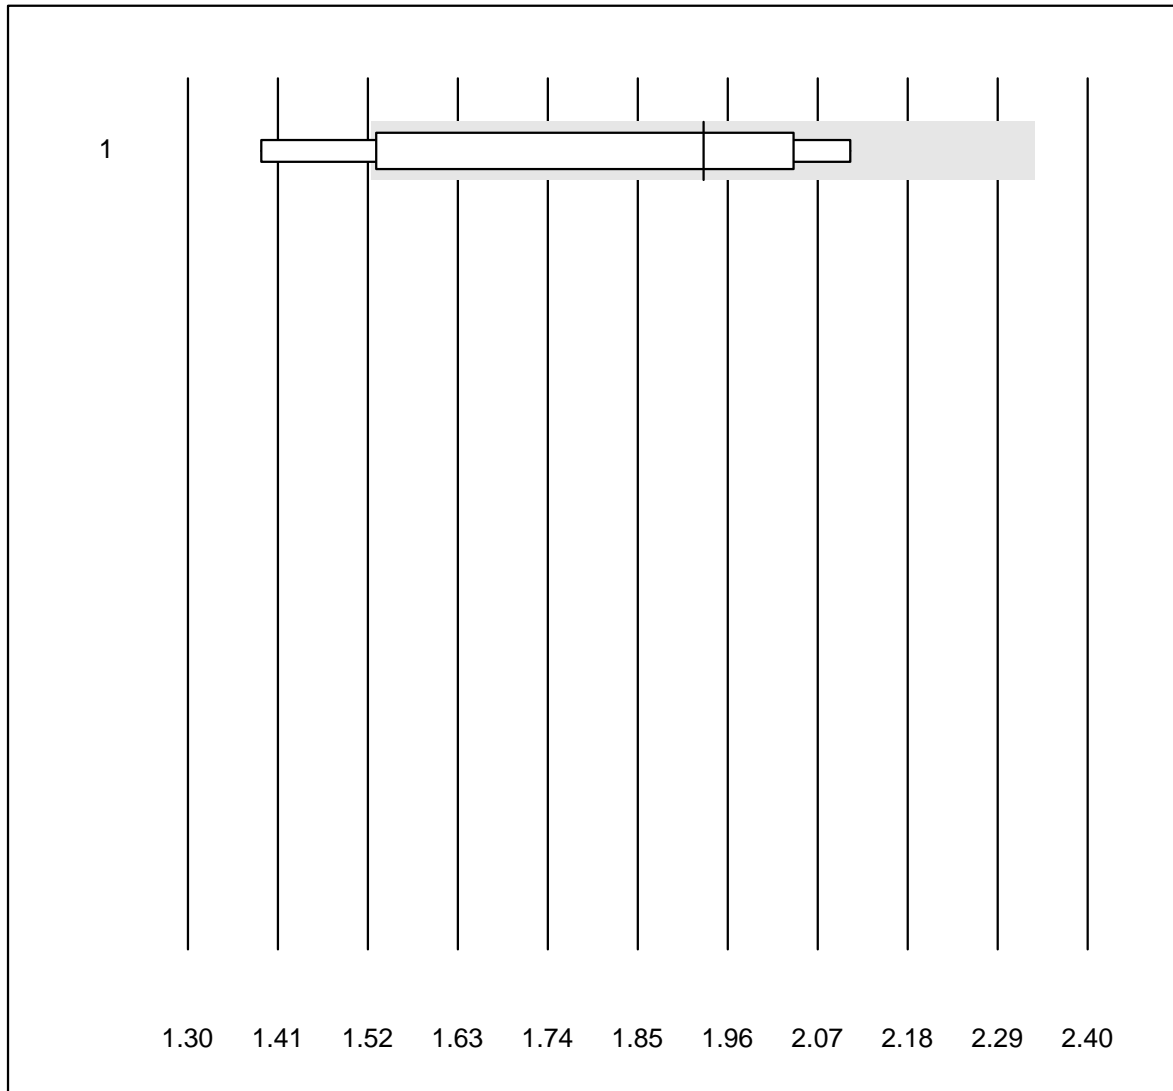


QUALAB Toleranz : 21 %

Cholesterin HDL PTS (mmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	CardioChek	9	77.8	11.1	11.1	1.93	15.0	e*

Triglyceride PTS

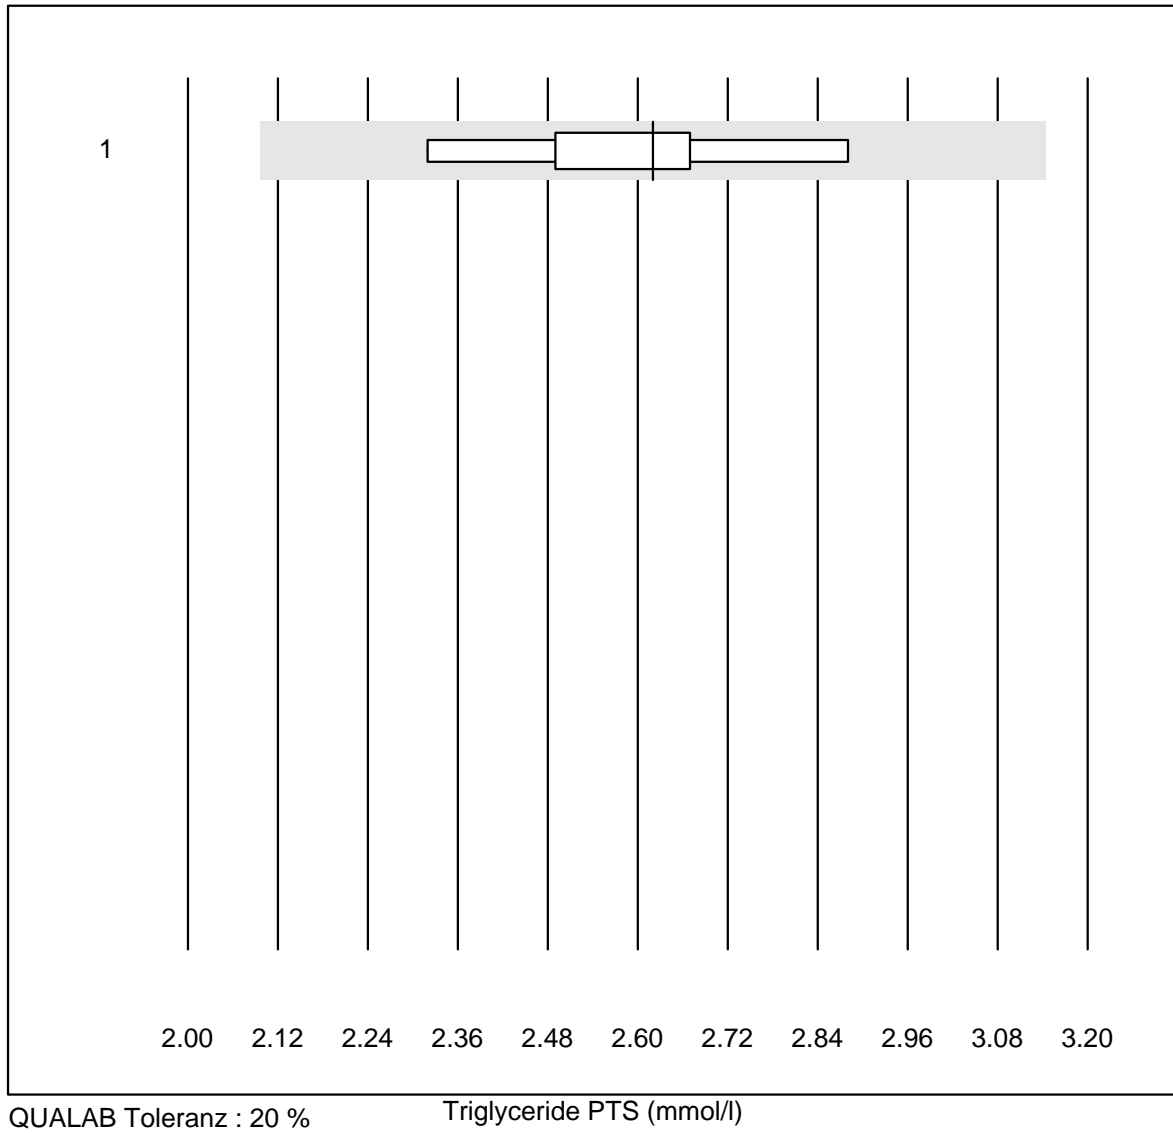


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 CardioChek	9	100.0	0.0	0.0	2.62	6.4	e

C-Peptid

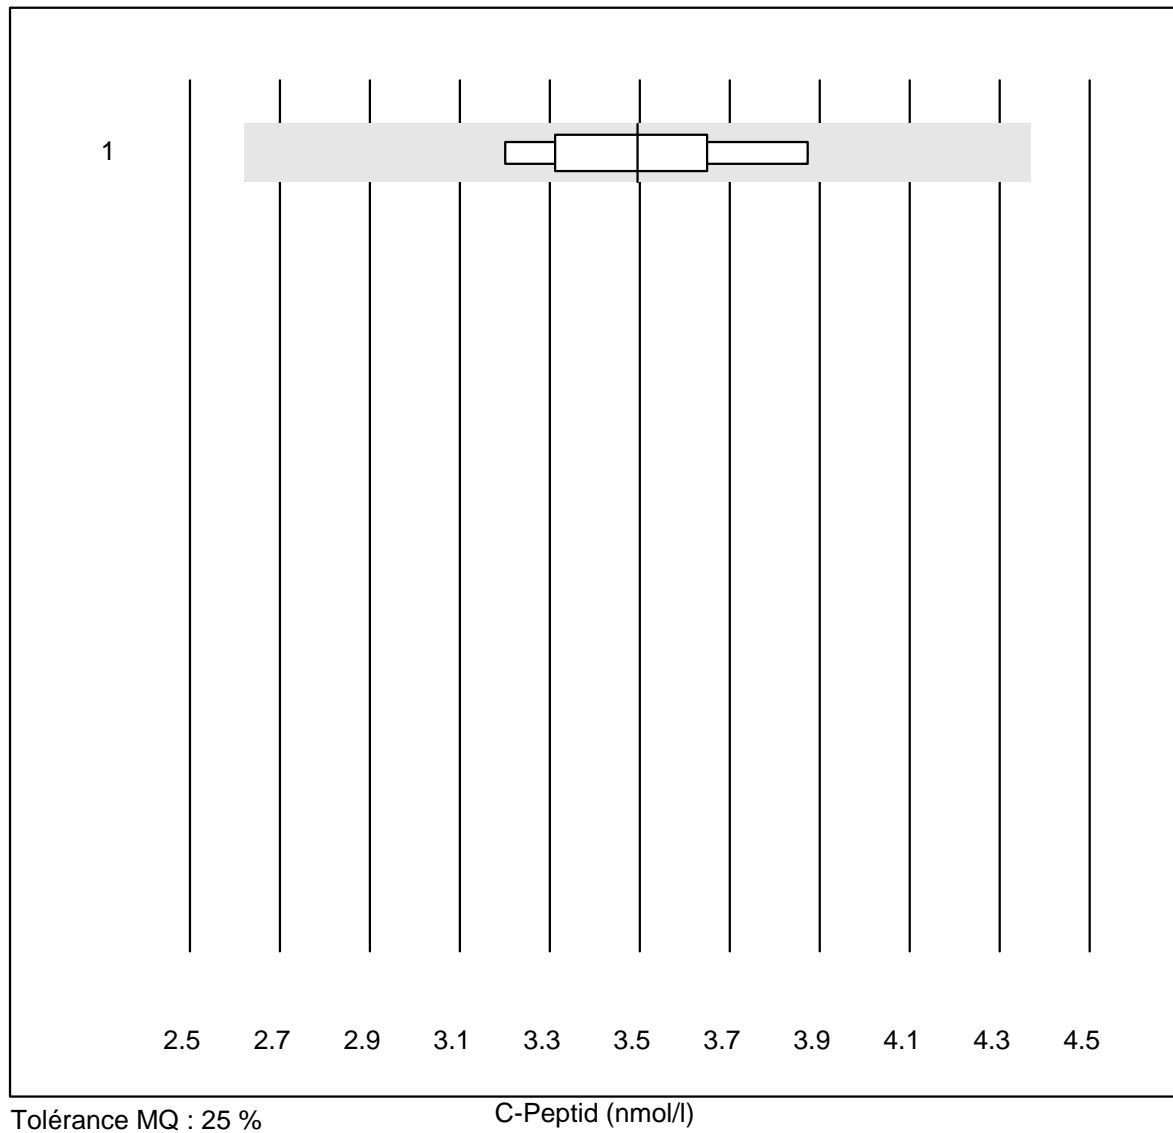


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	3.5	7.0	e

Procalcitonine

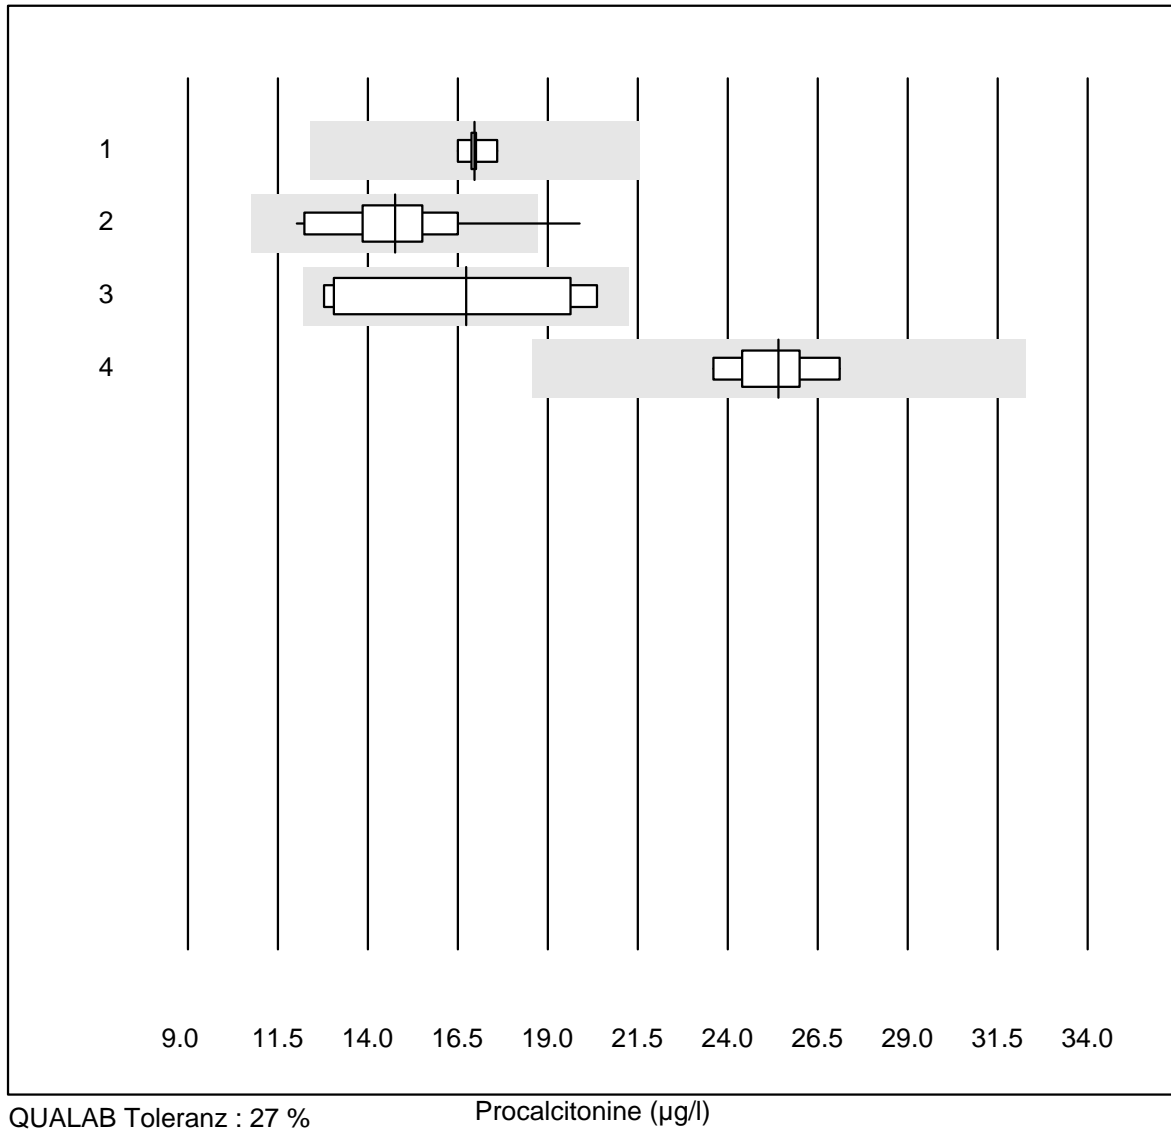

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	16.97	2.3	e
2 VIDAS	18	94.4	5.6	0.0	14.75	12.2	e
3 Autres méthodes	8	75.0	0.0	25.0	16.74	22.5	e*
4 Liaison	5	100.0	0.0	0.0	25.41	5.4	e

EPO

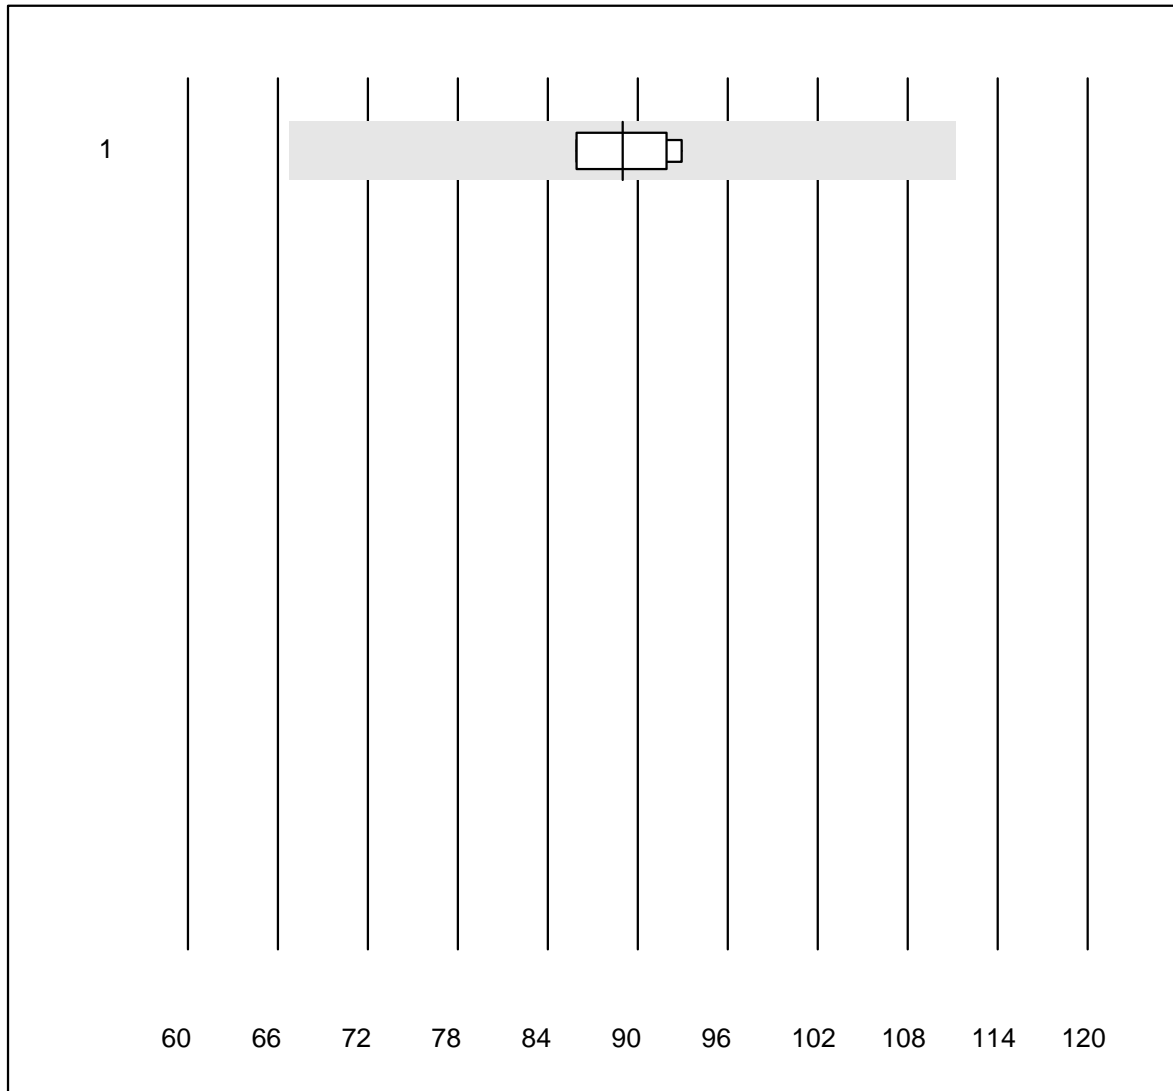


Tolérance MQ : 25 %

EPO (U/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Immulite	4	100.0	0.0	0.0	89.0	3.5	a

Parathormone

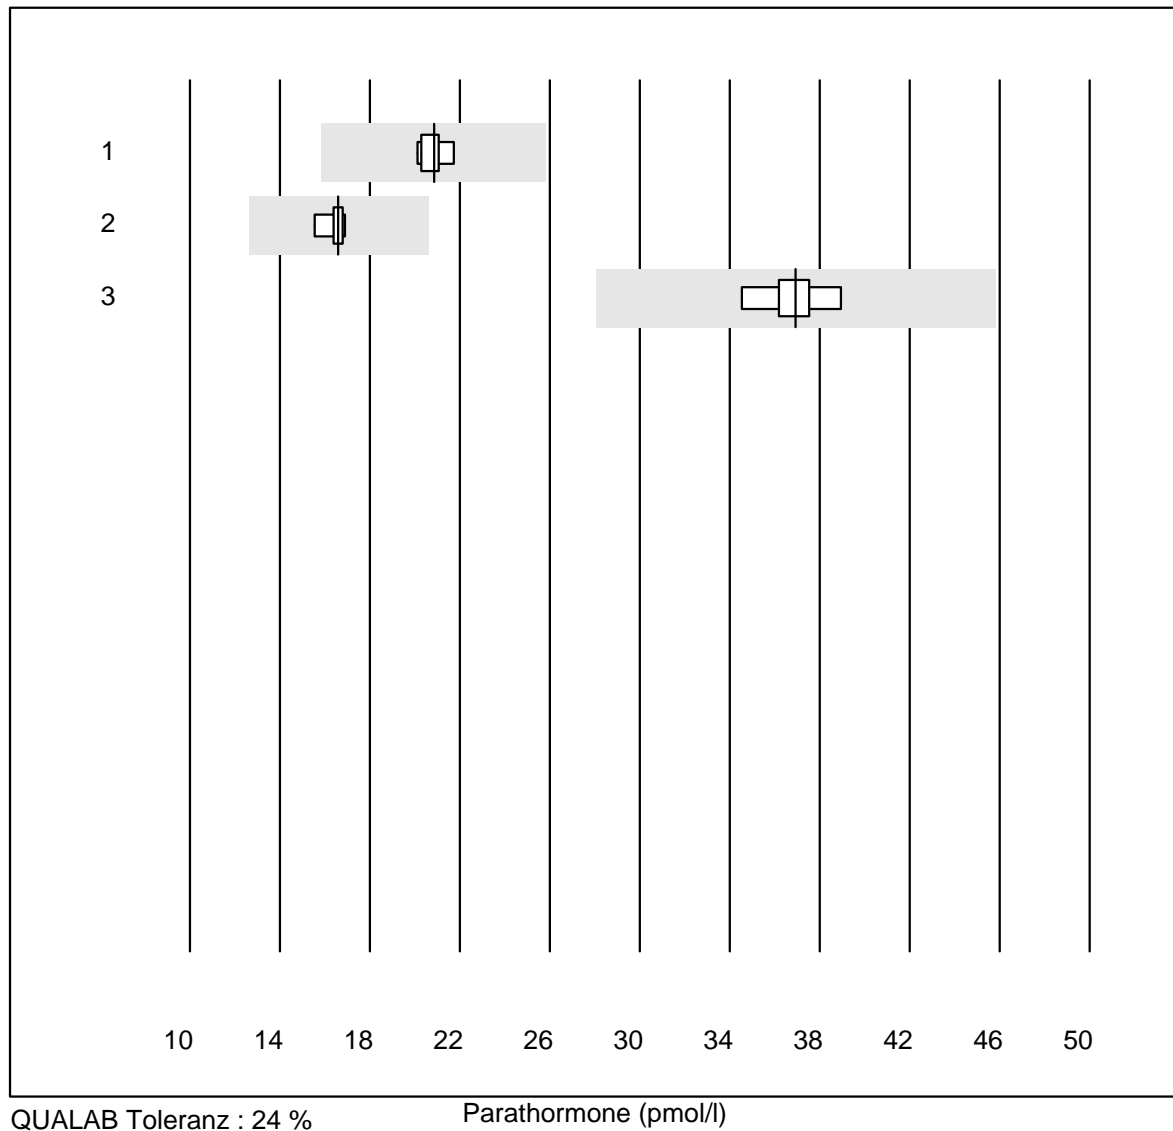


QUALAB Toleranz : 24 %

Parathormone (pmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas PTH STAT	5	100.0	0.0	0.0	20.8	3.1	e
2	Cobas	5	100.0	0.0	0.0	16.6	3.3	e
3	Architect	5	100.0	0.0	0.0	36.9	4.4	e

Osmolalität

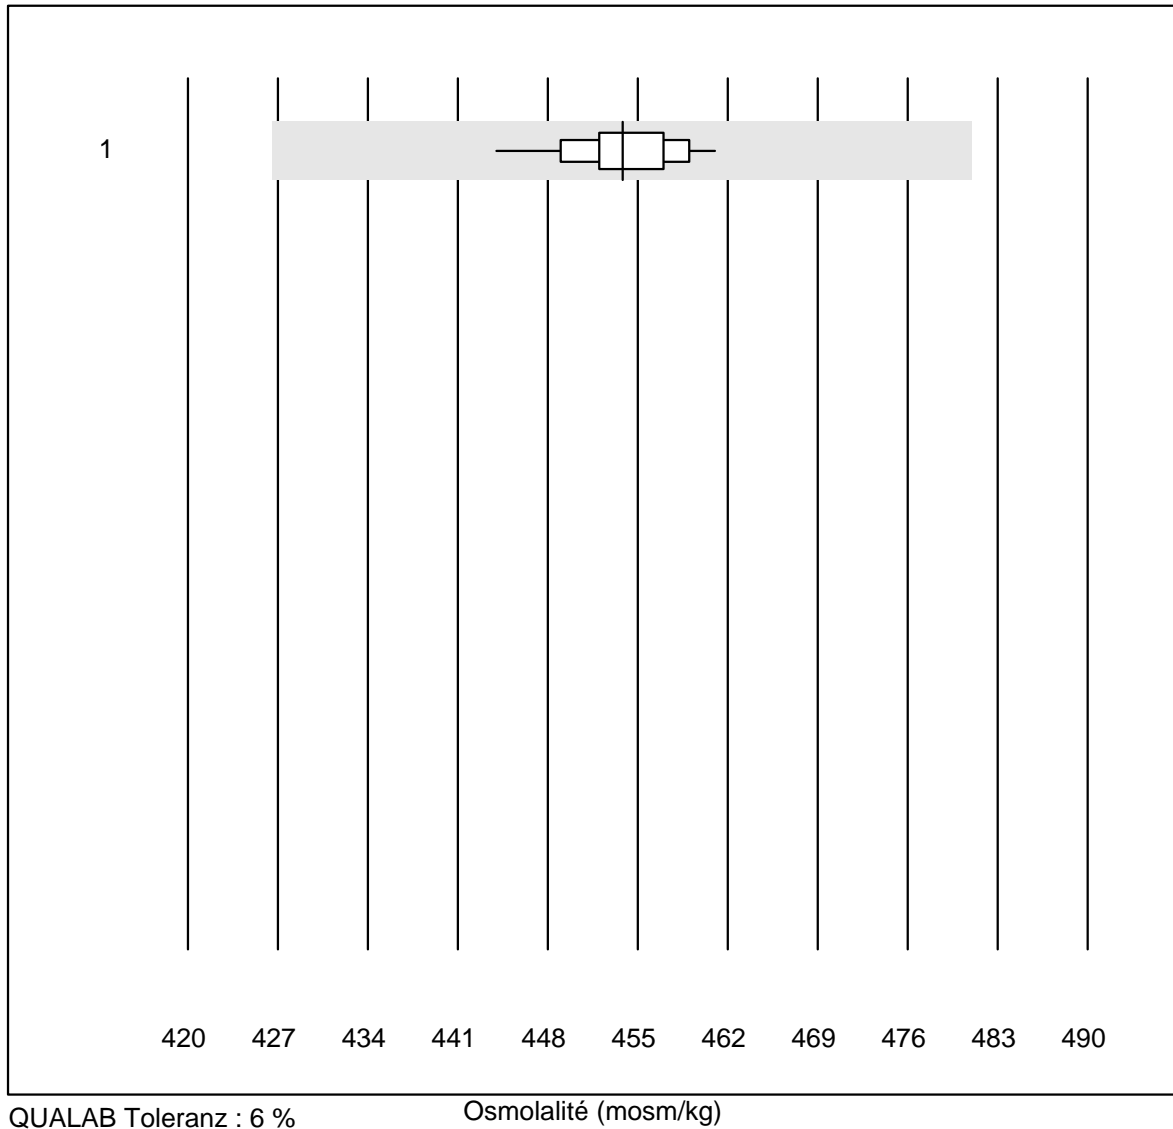

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cryoscopie	15	100.0	0.0	0.0	454	0.9	e

Kalium-K22

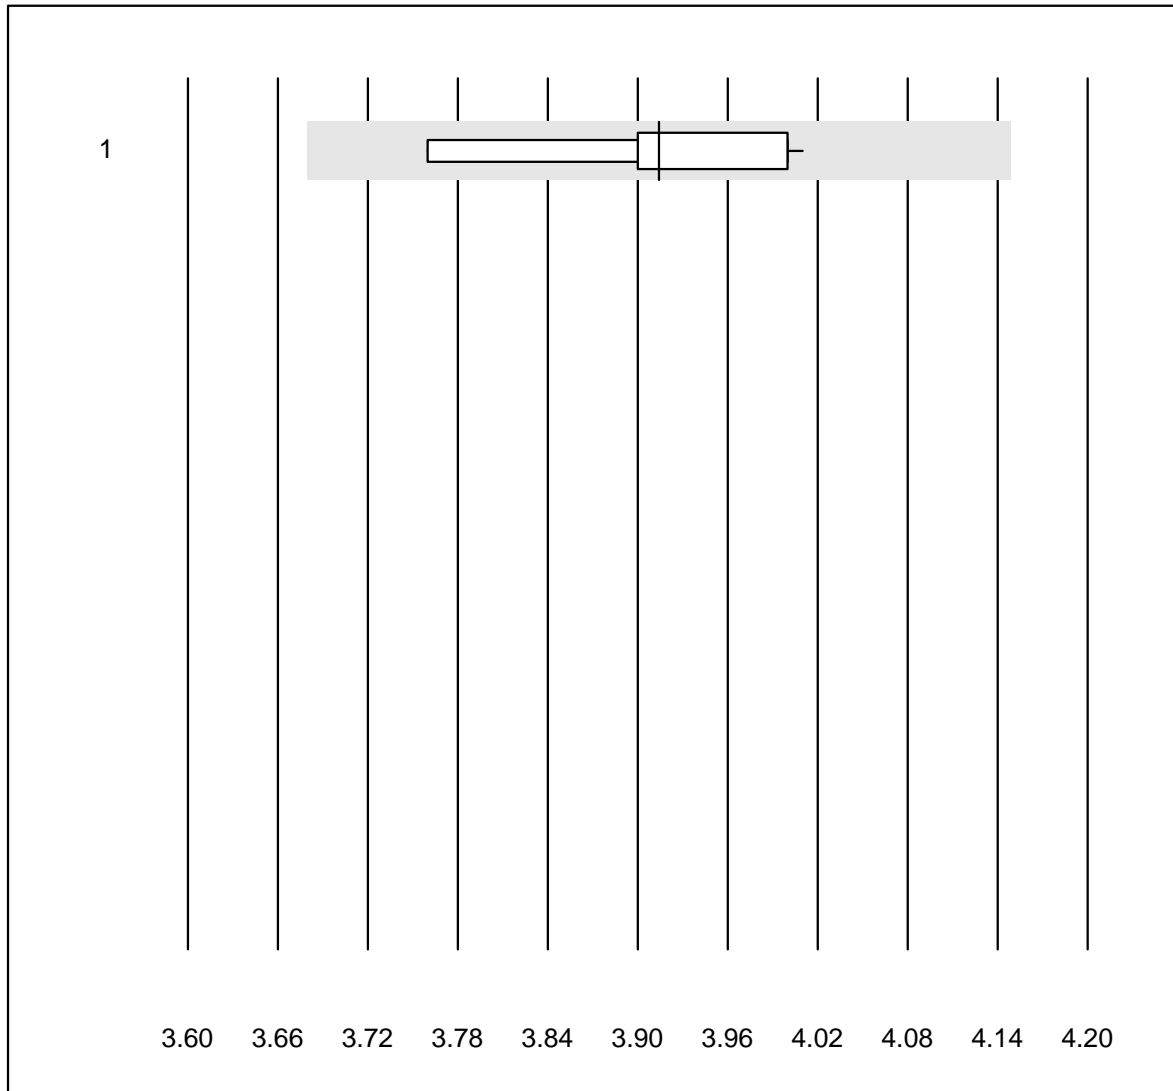


QUALAB Toleranz : 6 %

Kalium-K22 (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 ISE	10	100.0	0.0	0.0	3.9	1.9	e

Natrium-K22

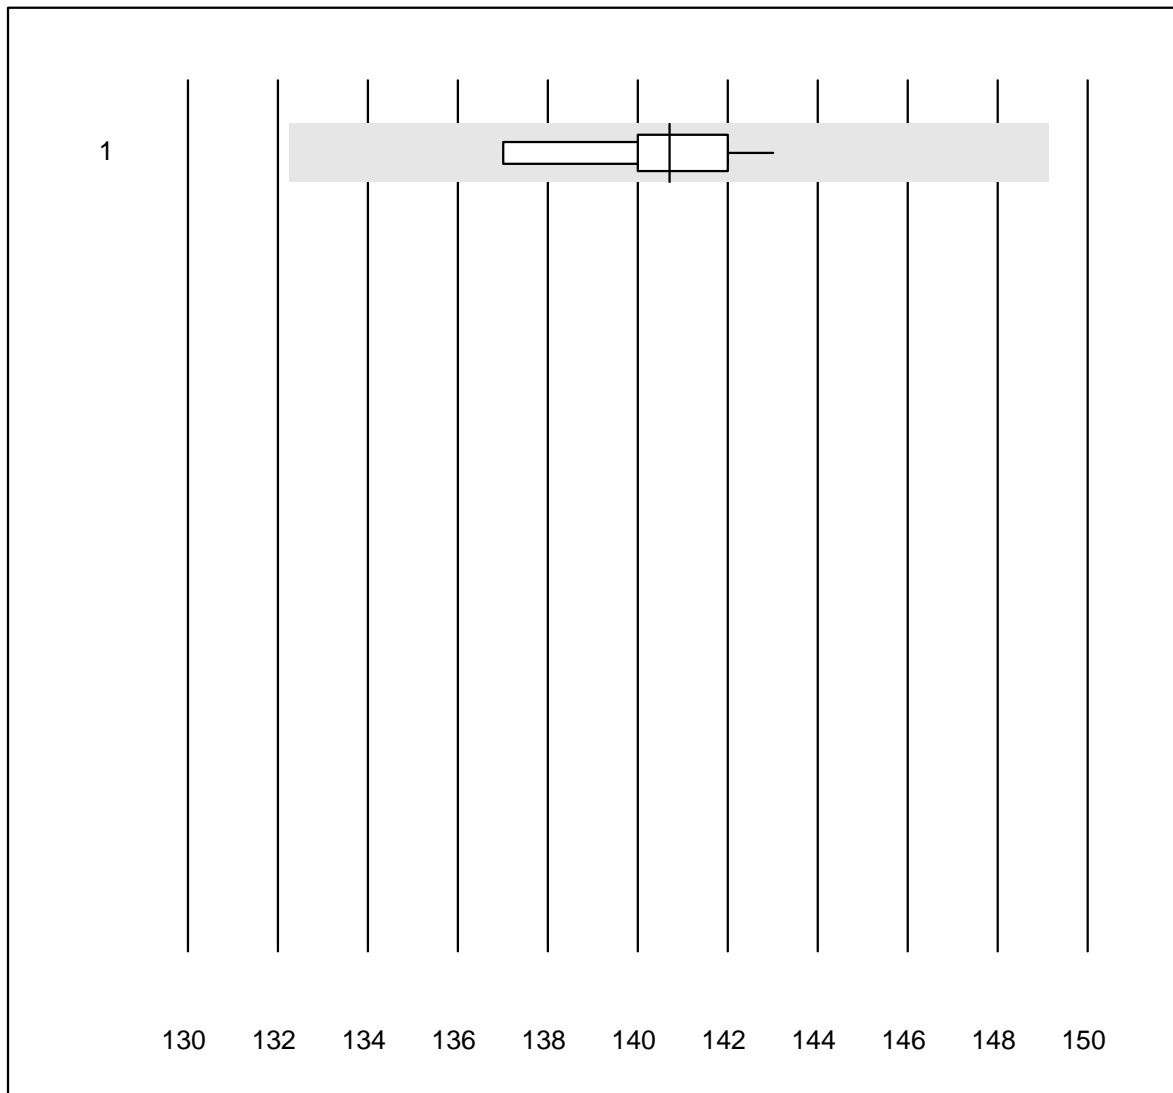


QUALAB Toleranz : 6 %

Natrium-K22 (mmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ISE	10	100.0	0.0	0.0	141	1.2	e

Glukose-K22

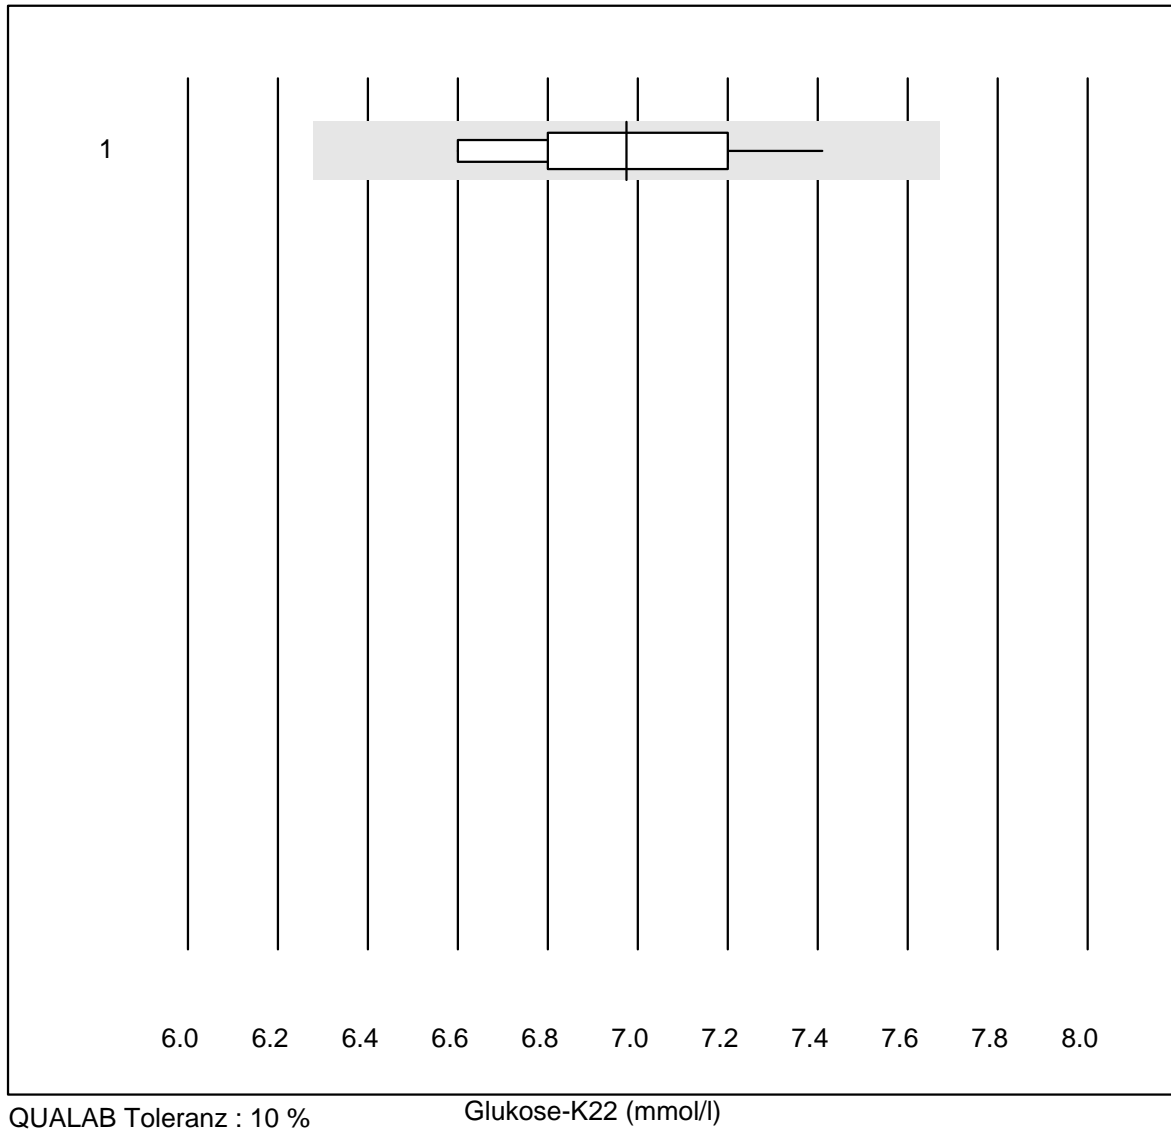


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	10	100.0	0.0	0.0	7.0	3.7	e

Harnstoff-K22

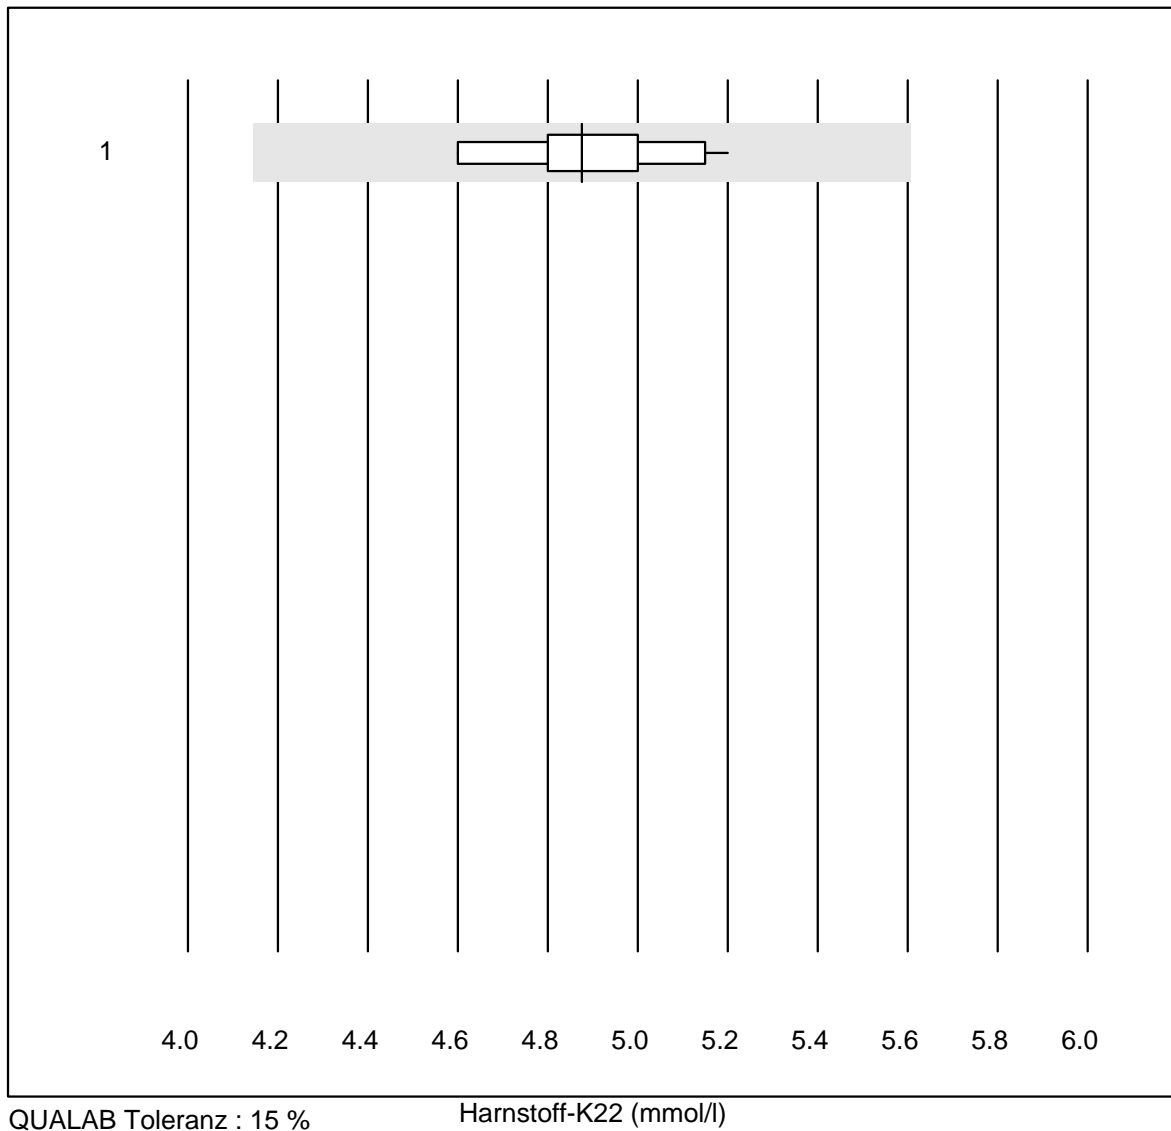


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	10	100.0	0.0	0.0	4.9	3.9	e

Osmotische Lücke

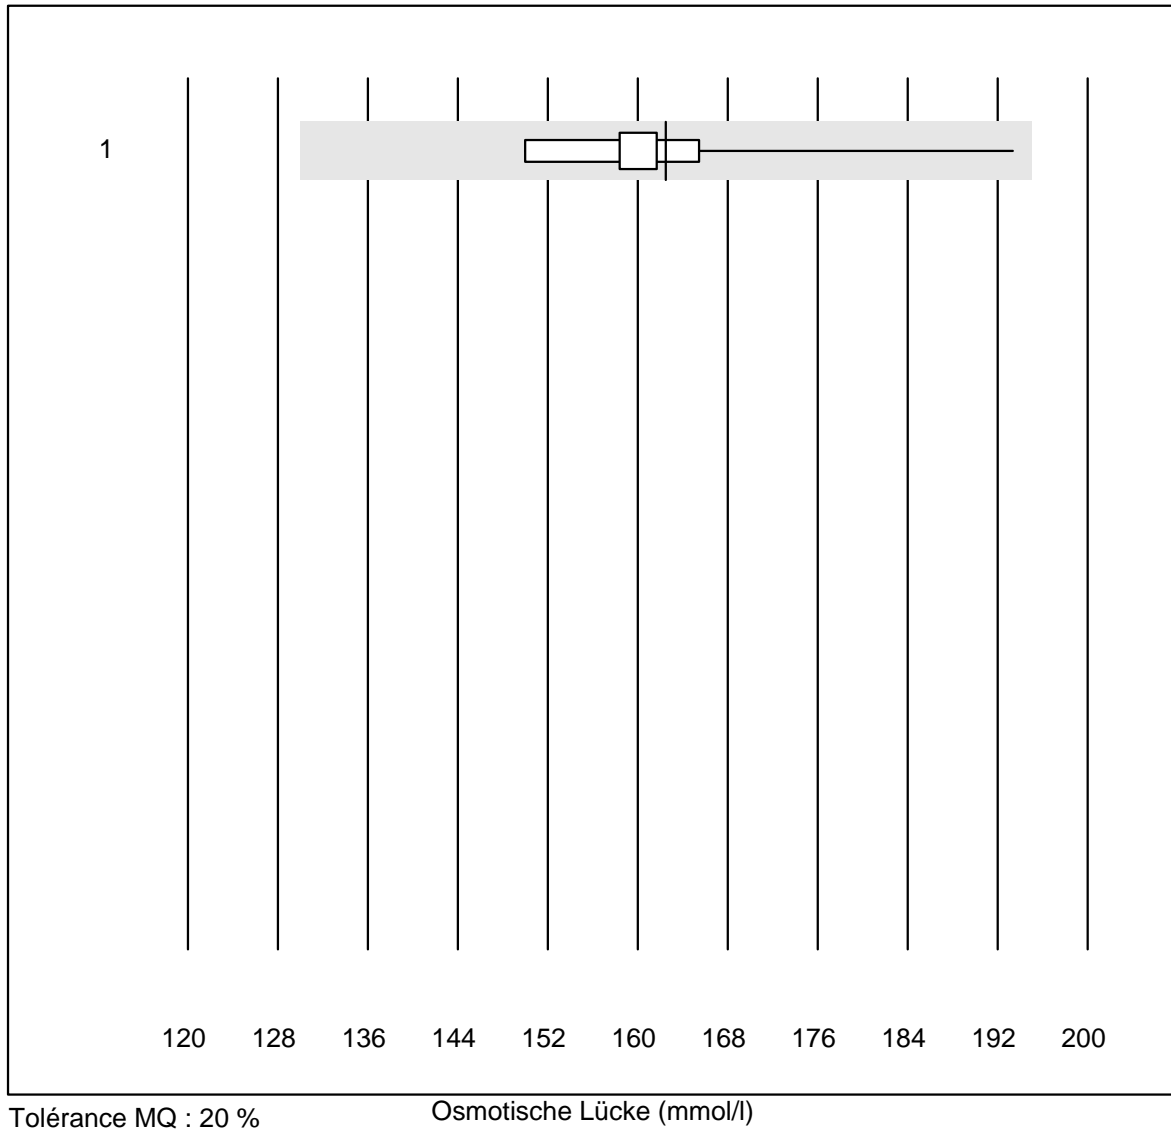

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Formel 1 (2Na+K+Glu+	10	100.0	0.0	0.0	162.5	7.1	e

Digoxin

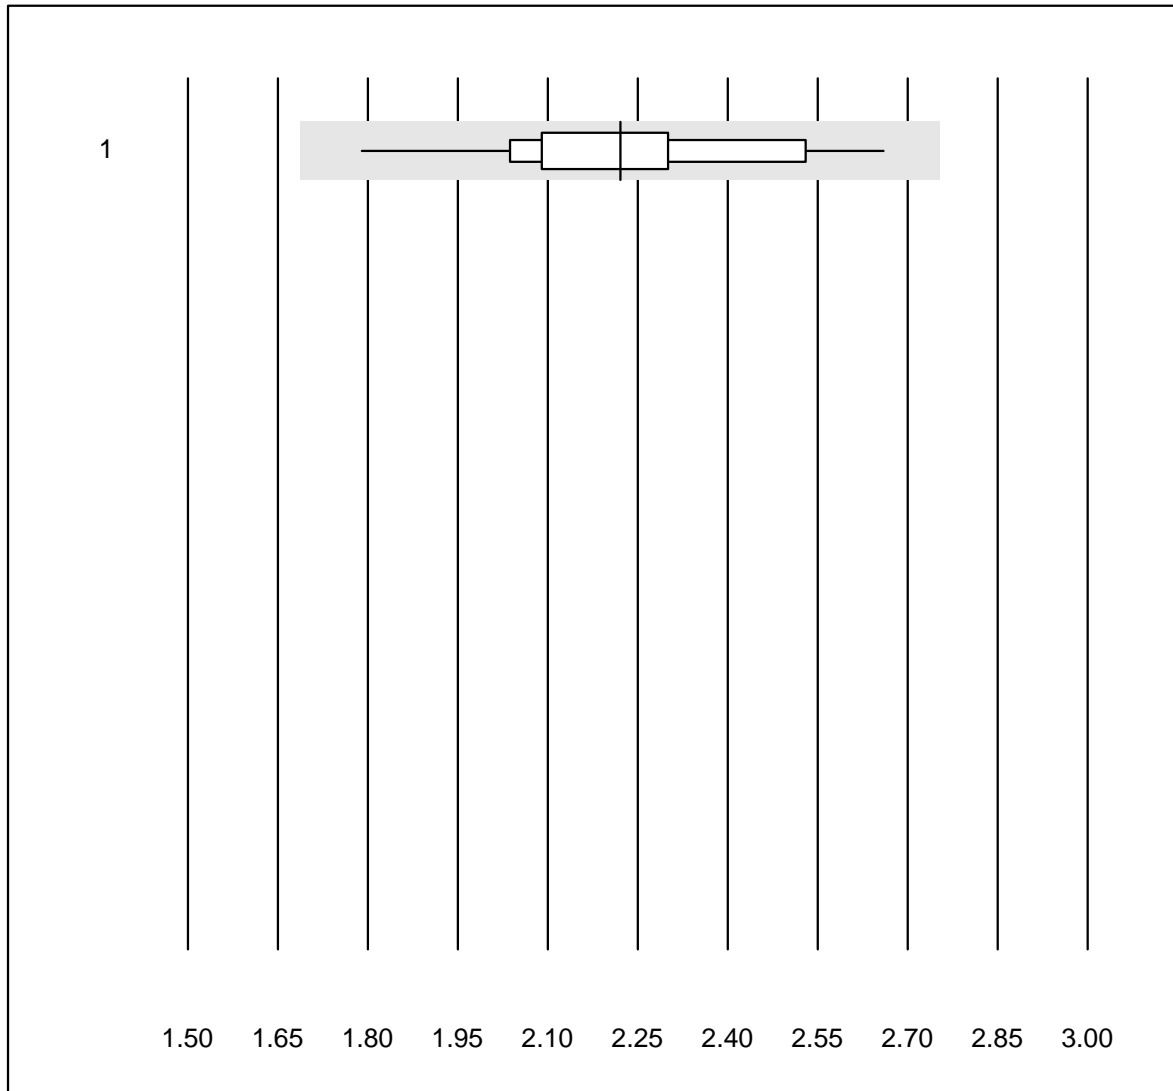


QUALAB Toleranz : 24 %

Digoxin (nmol/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Autres méthodes	12	100.0	0.0	0.0	2.22	10.3	e*

Phénytoïn

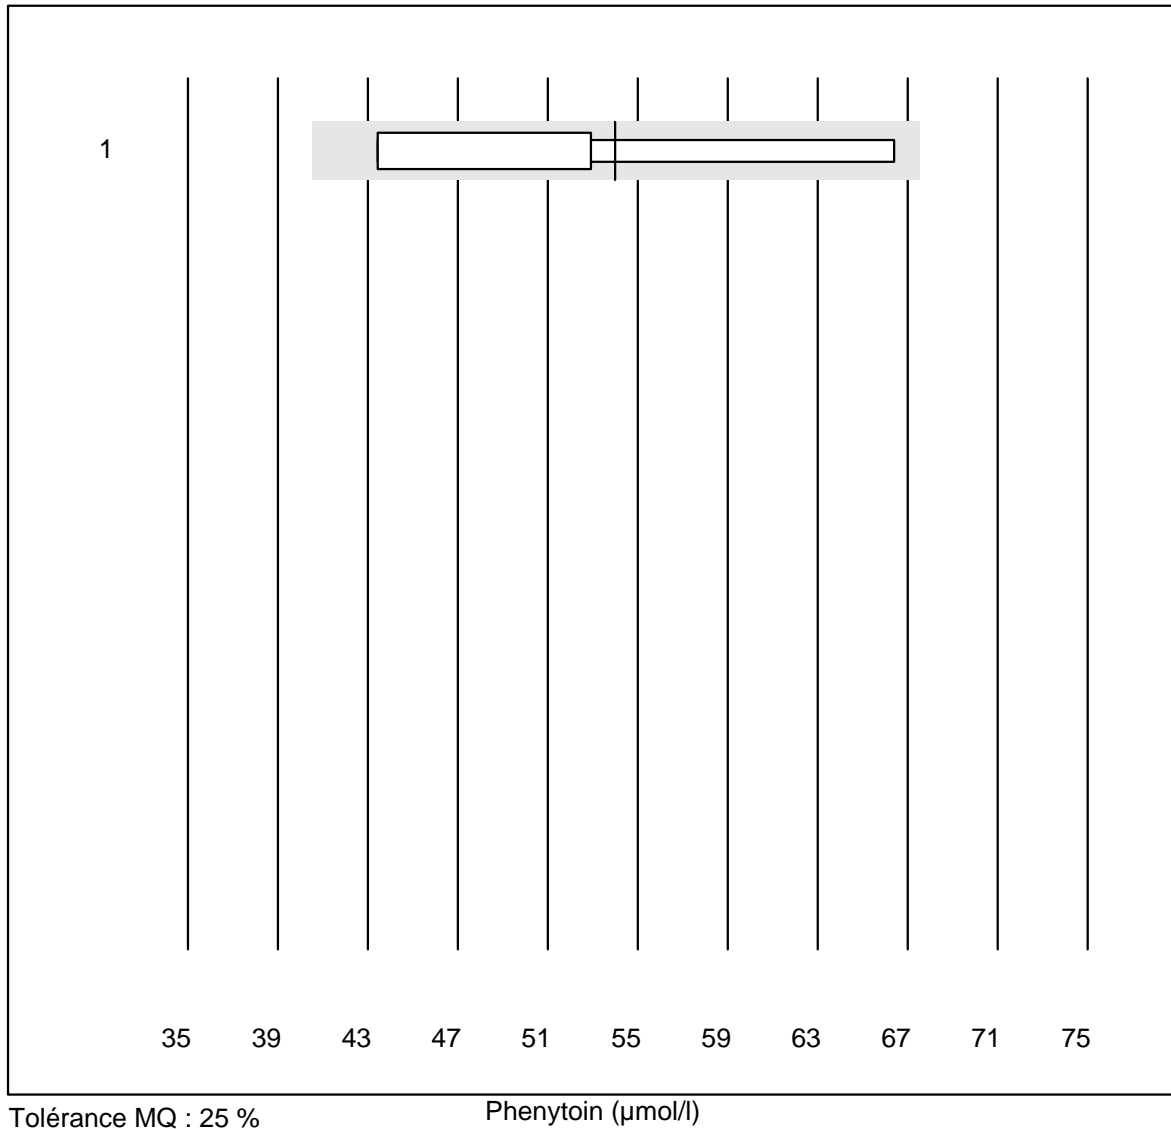


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	54	18.4	a

Phenobarbital

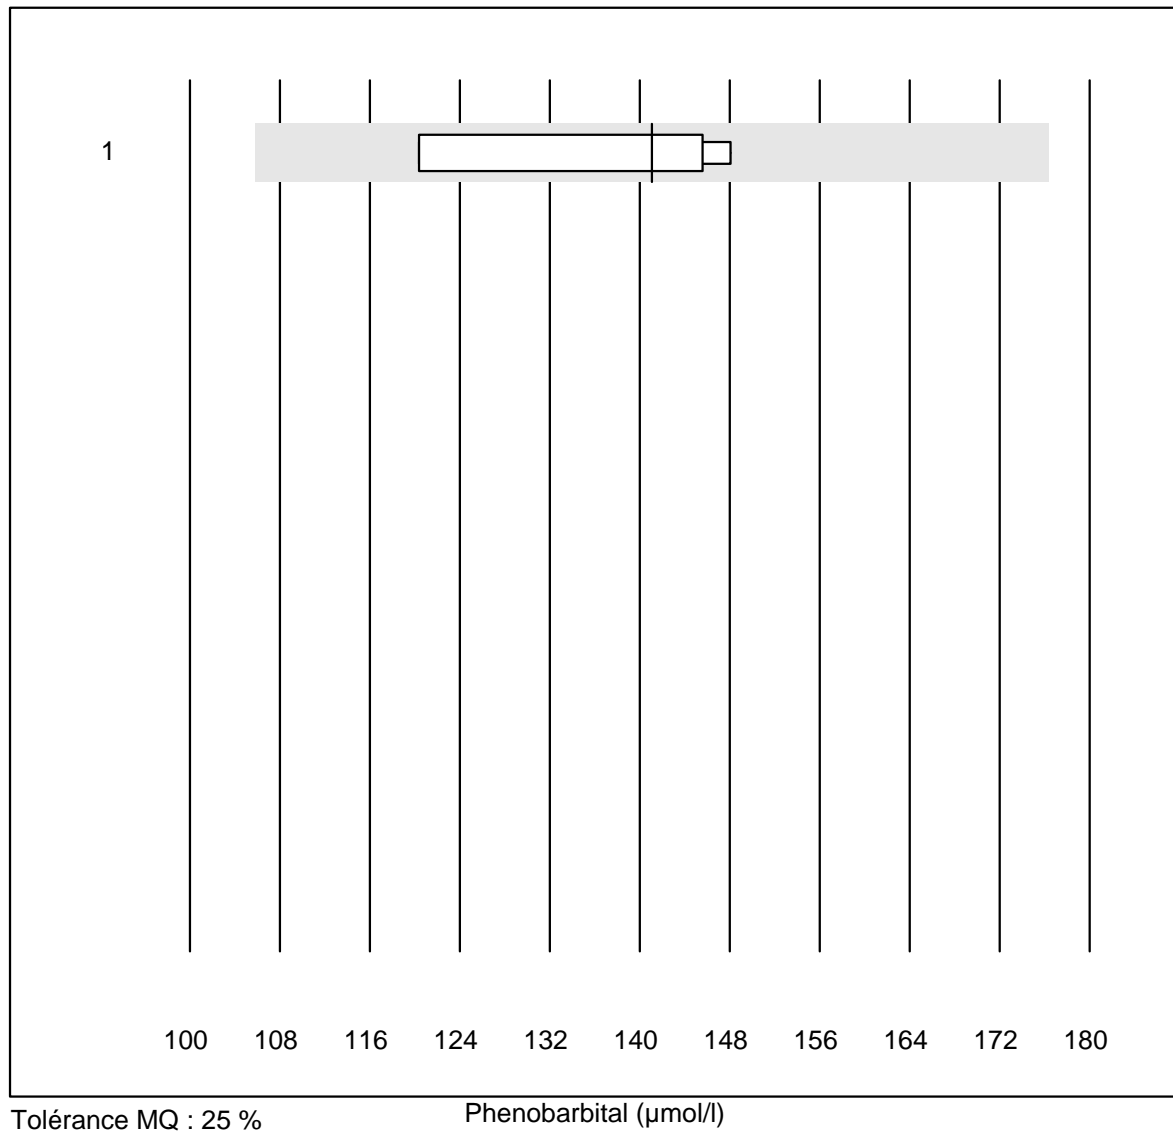


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	141	9.1	e*

Paracetamol

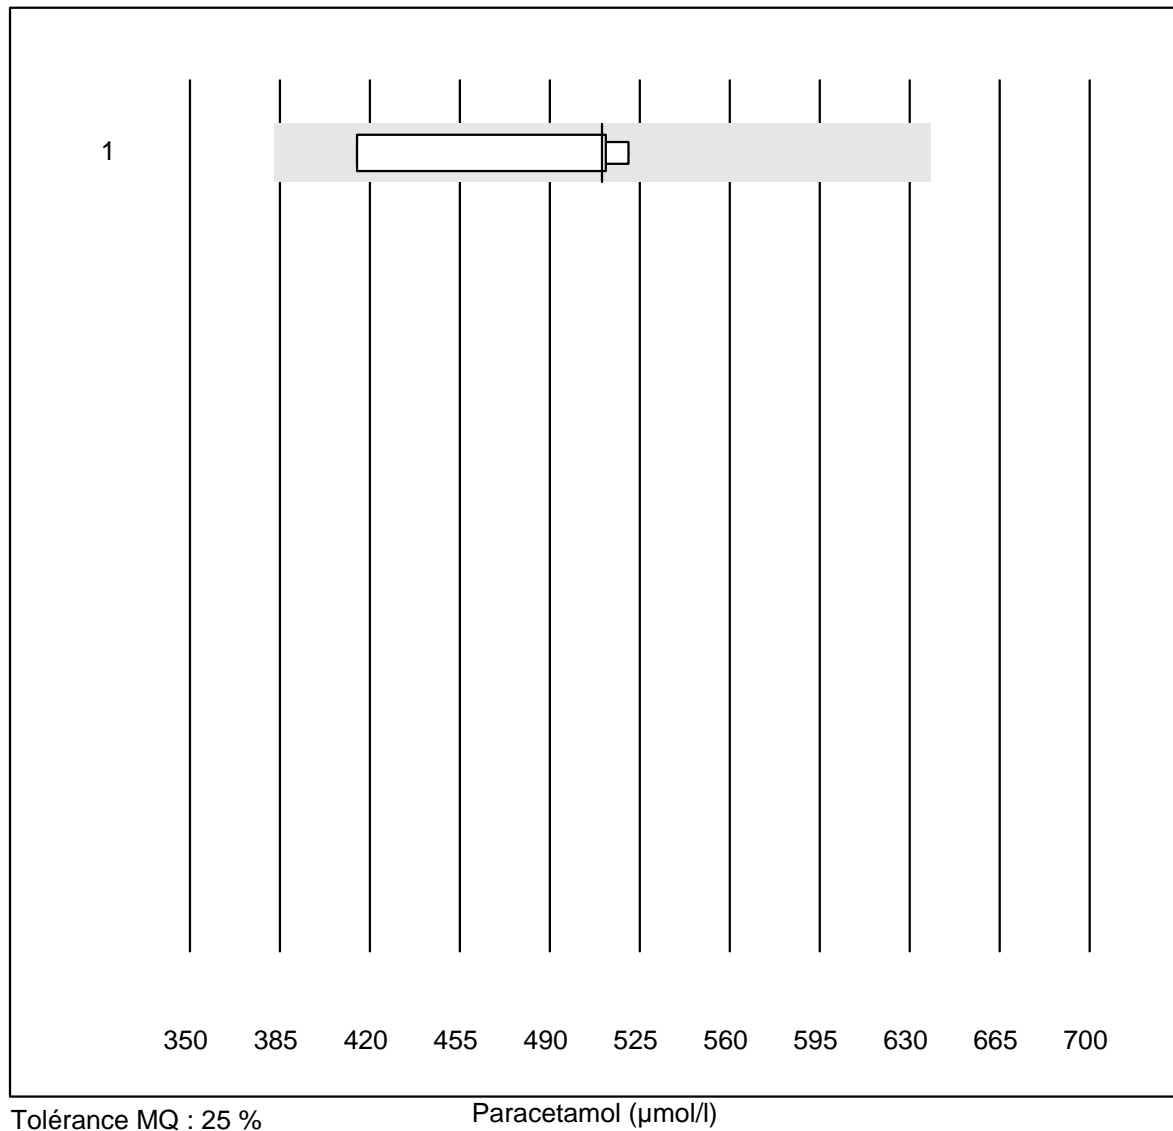

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	510.4	10.1	e*

Valproat

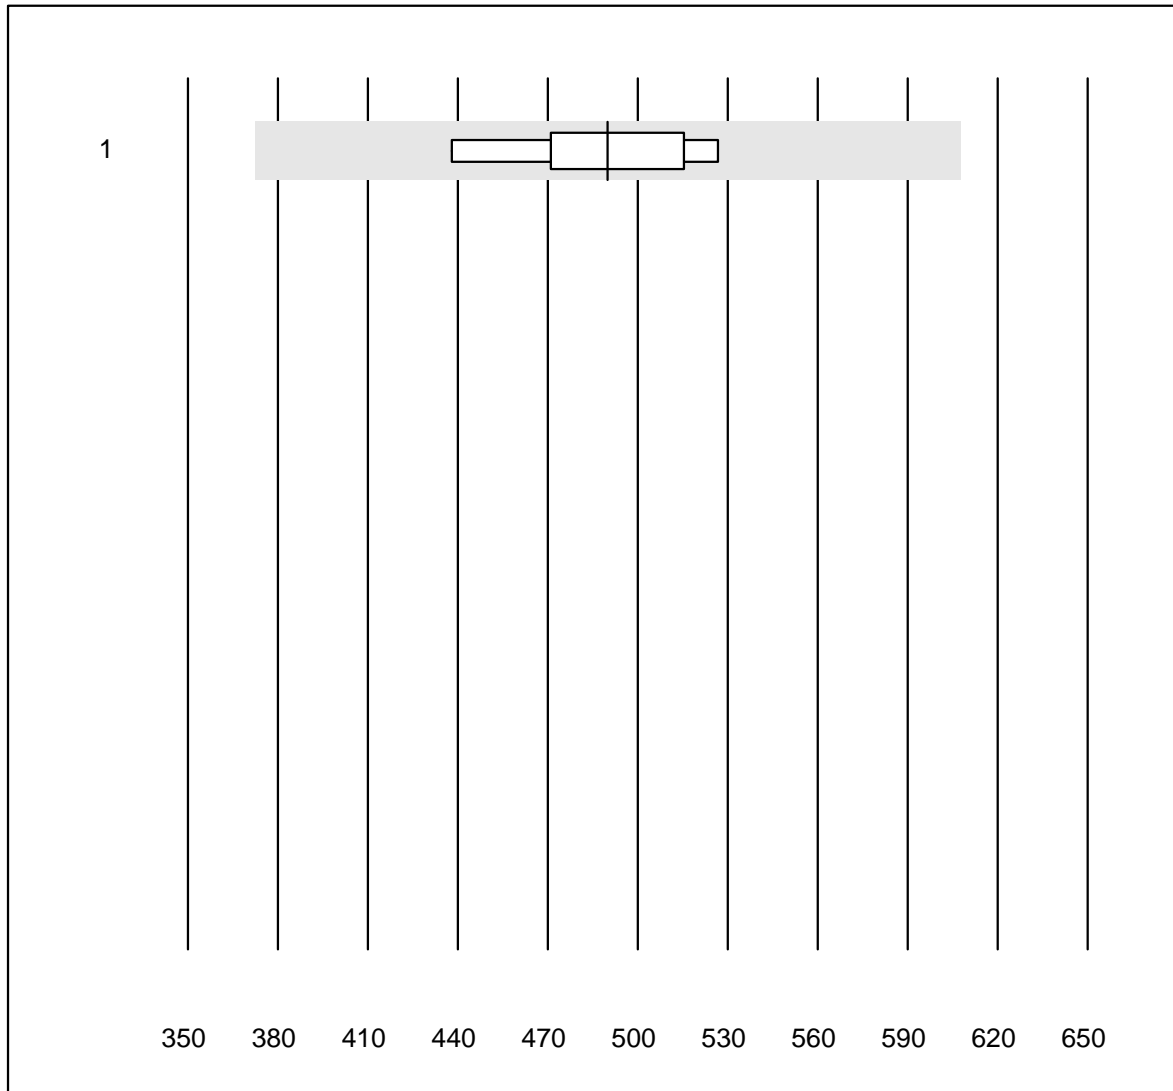


Tolérance MQ : 24 %

Valproat (µmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	490.0	6.2	e

Cystatin C

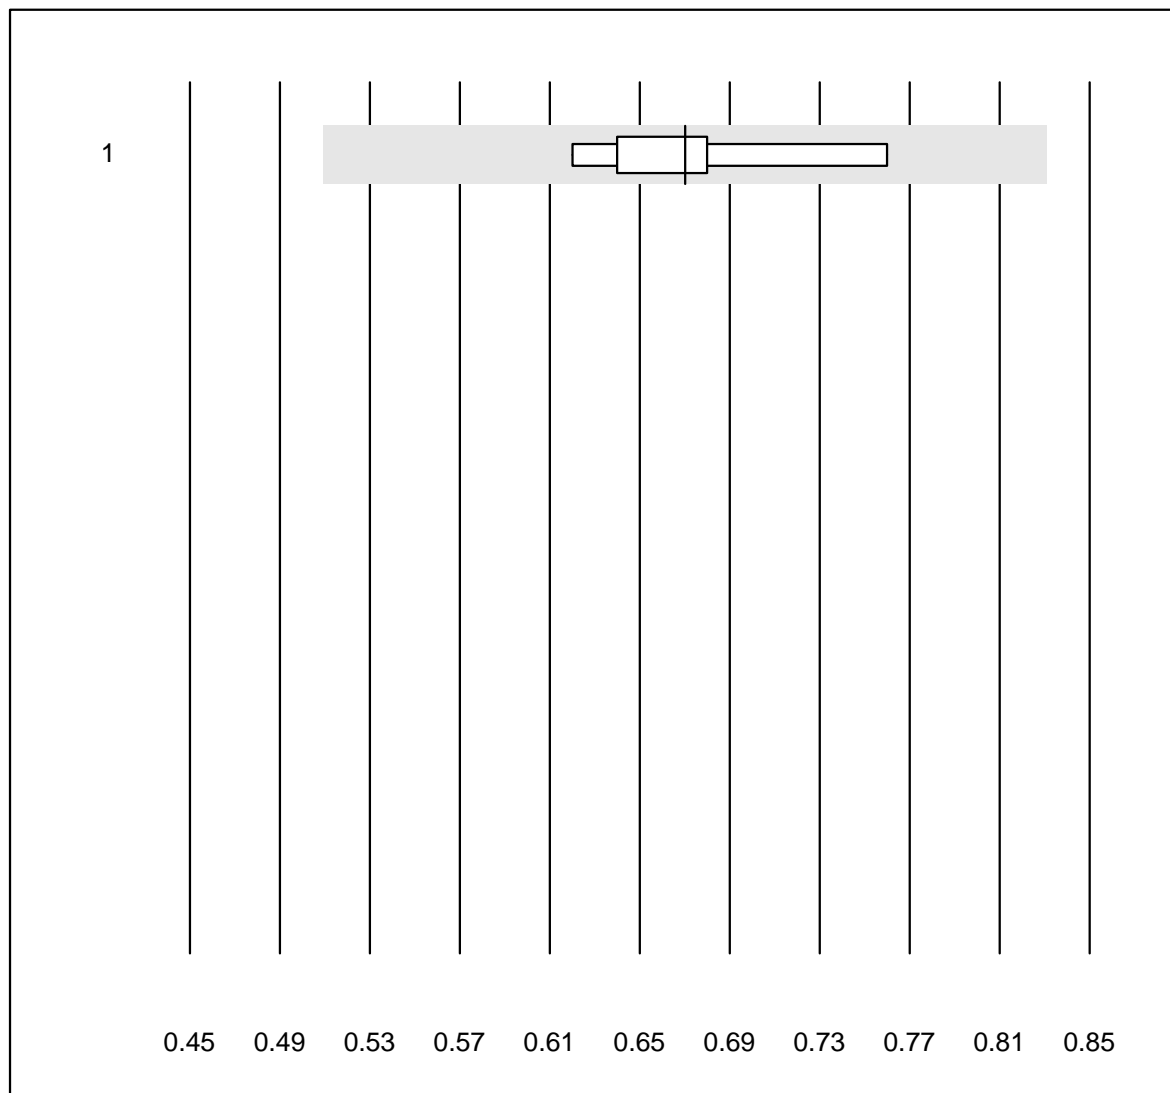


Tolérance MQ : 24 %

Cystatin C (mg/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	9	100.0	0.0	0.0	0.7	6.2	e

Éthanol

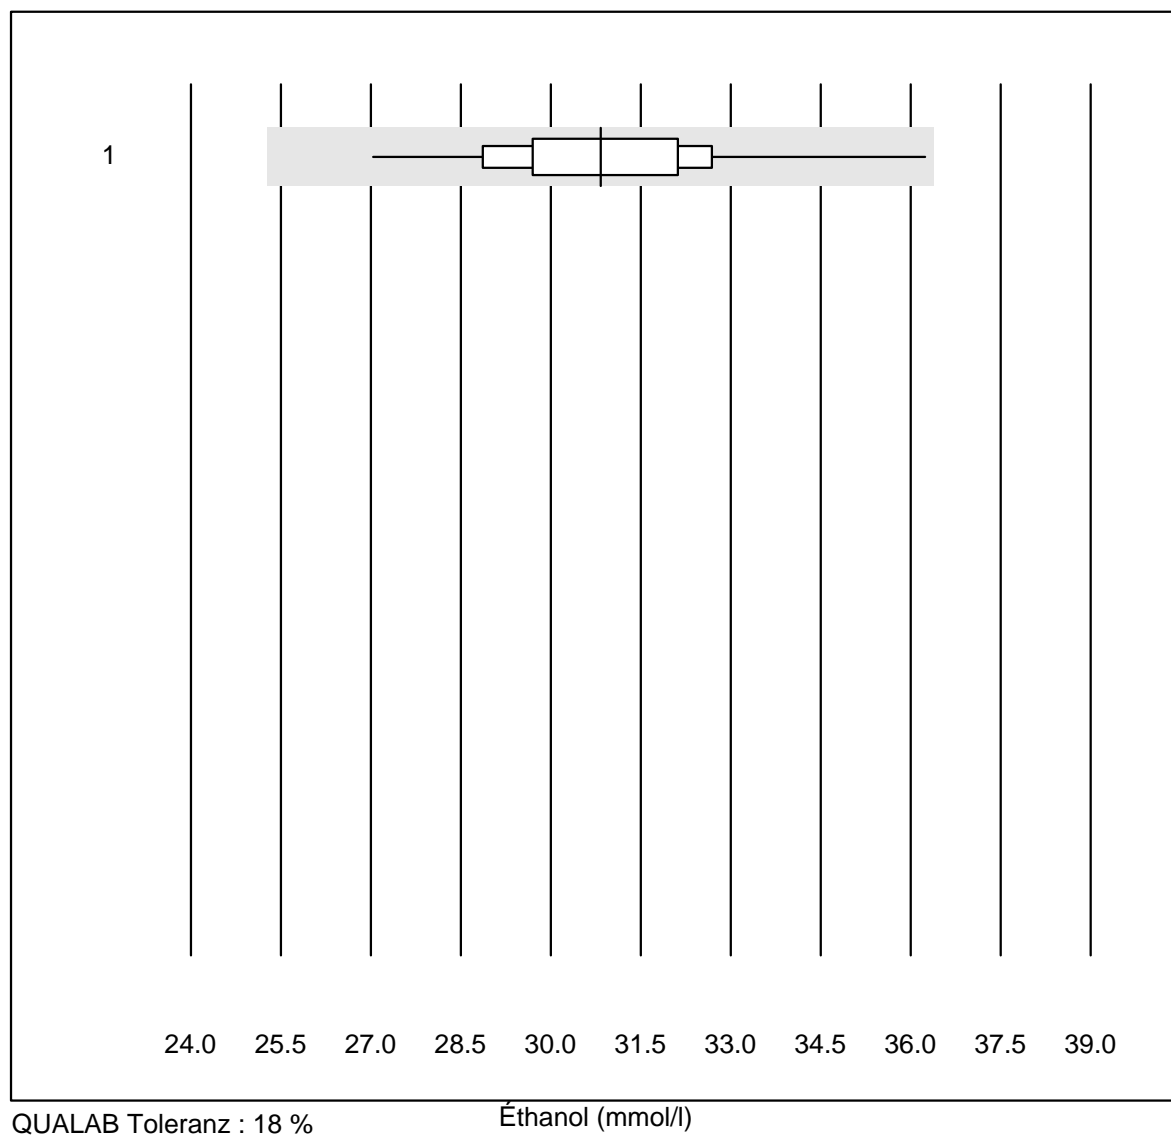


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	21	95.2	0.0	4.8	30.8	6.3	e

Ammoniac

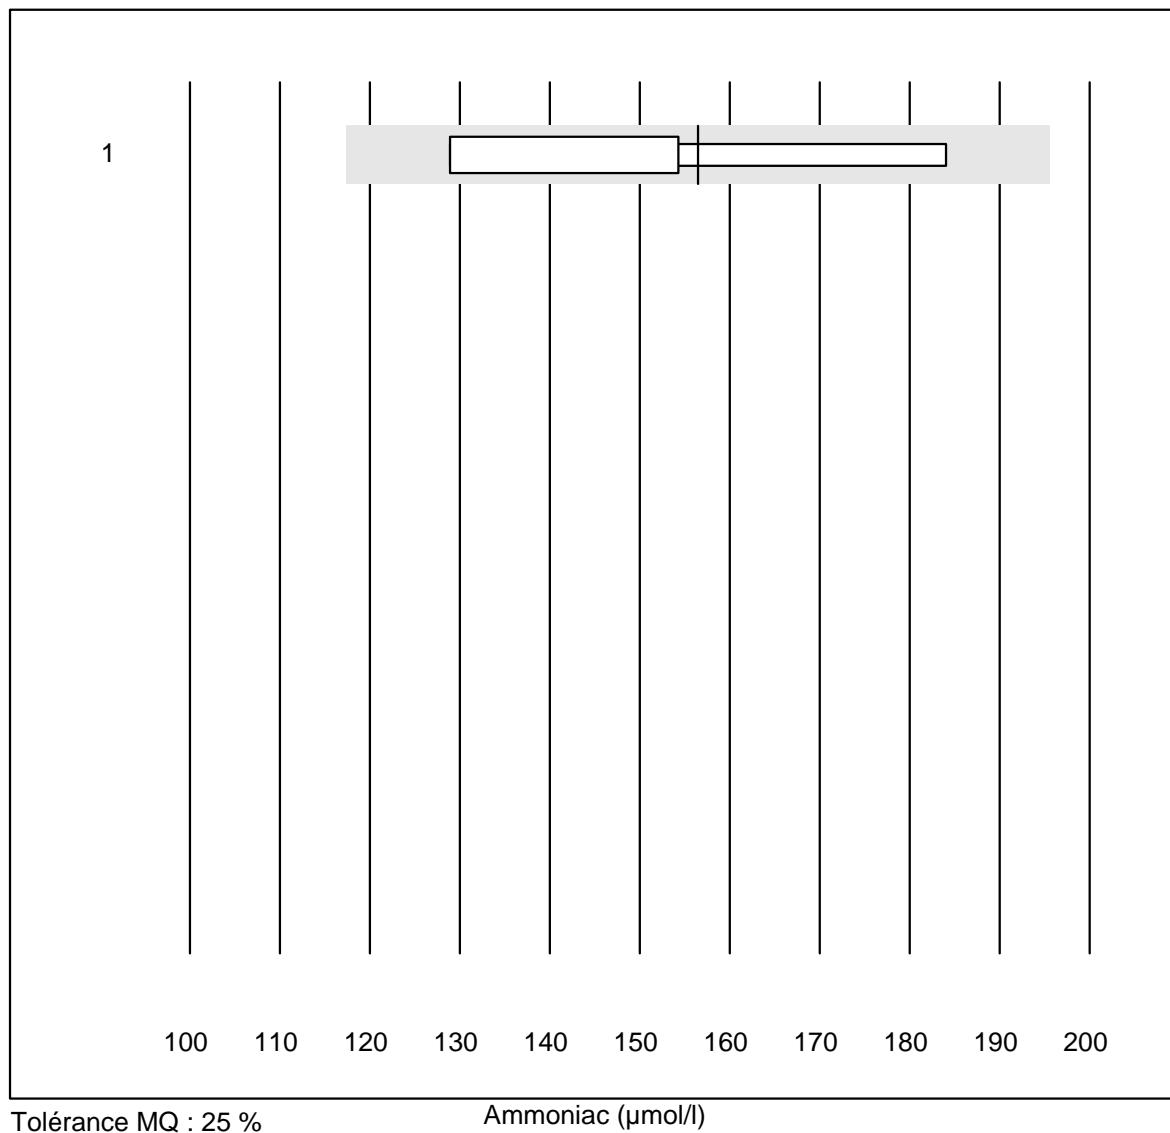


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	156.5	16.5	a

Calprotectin

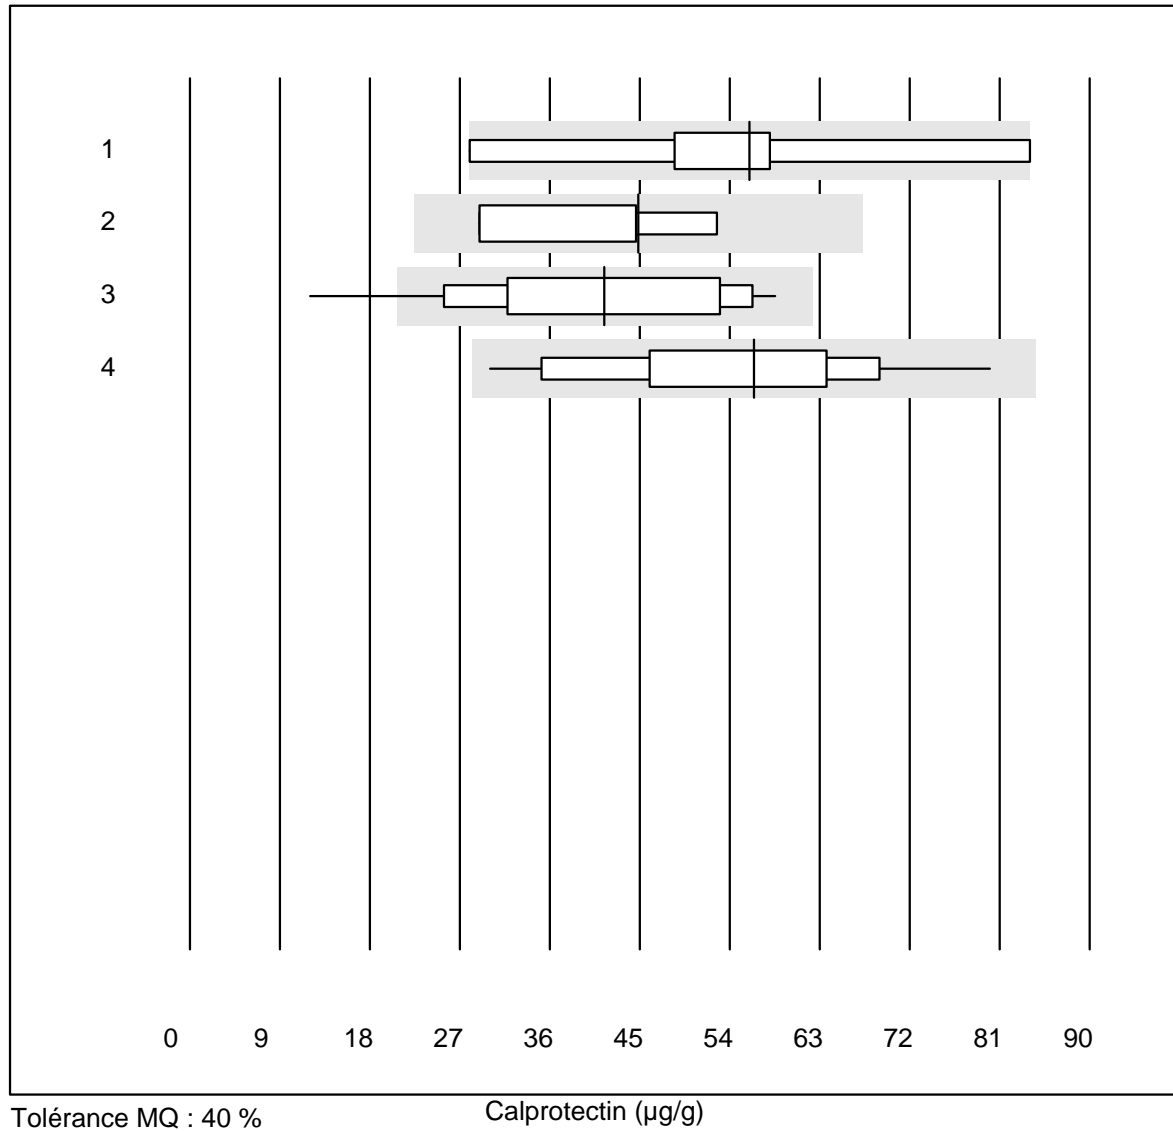


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Bühlmann fCALturbo	5	60.0	40.0	0.0	56	36.7	a
2	Ridas Screen DS2	4	100.0	0.0	0.0	45	24.9	a
3	Liaison	19	89.4	5.3	5.3	41	32.0	a
4	Bühlmann	16	93.7	0.0	6.3	56	25.5	a

Cholestérol Af/b101

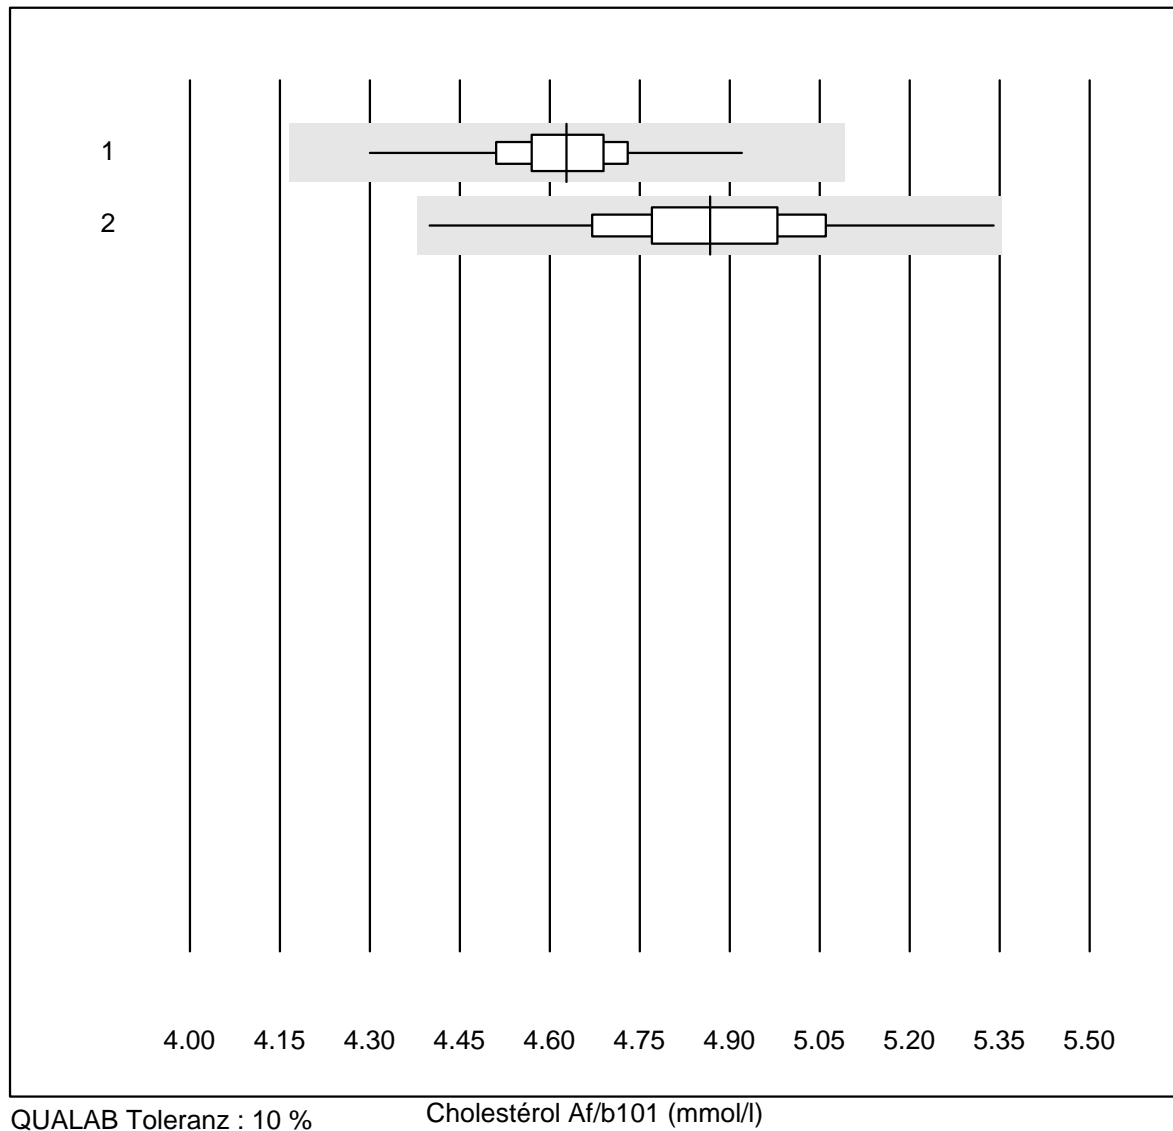

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas b101	122	97.5	0.0	2.5	4.63	2.0	e
2 Afinion	426	100.0	0.0	0.0	4.87	3.2	e

Cholestérol HDL Af/b101

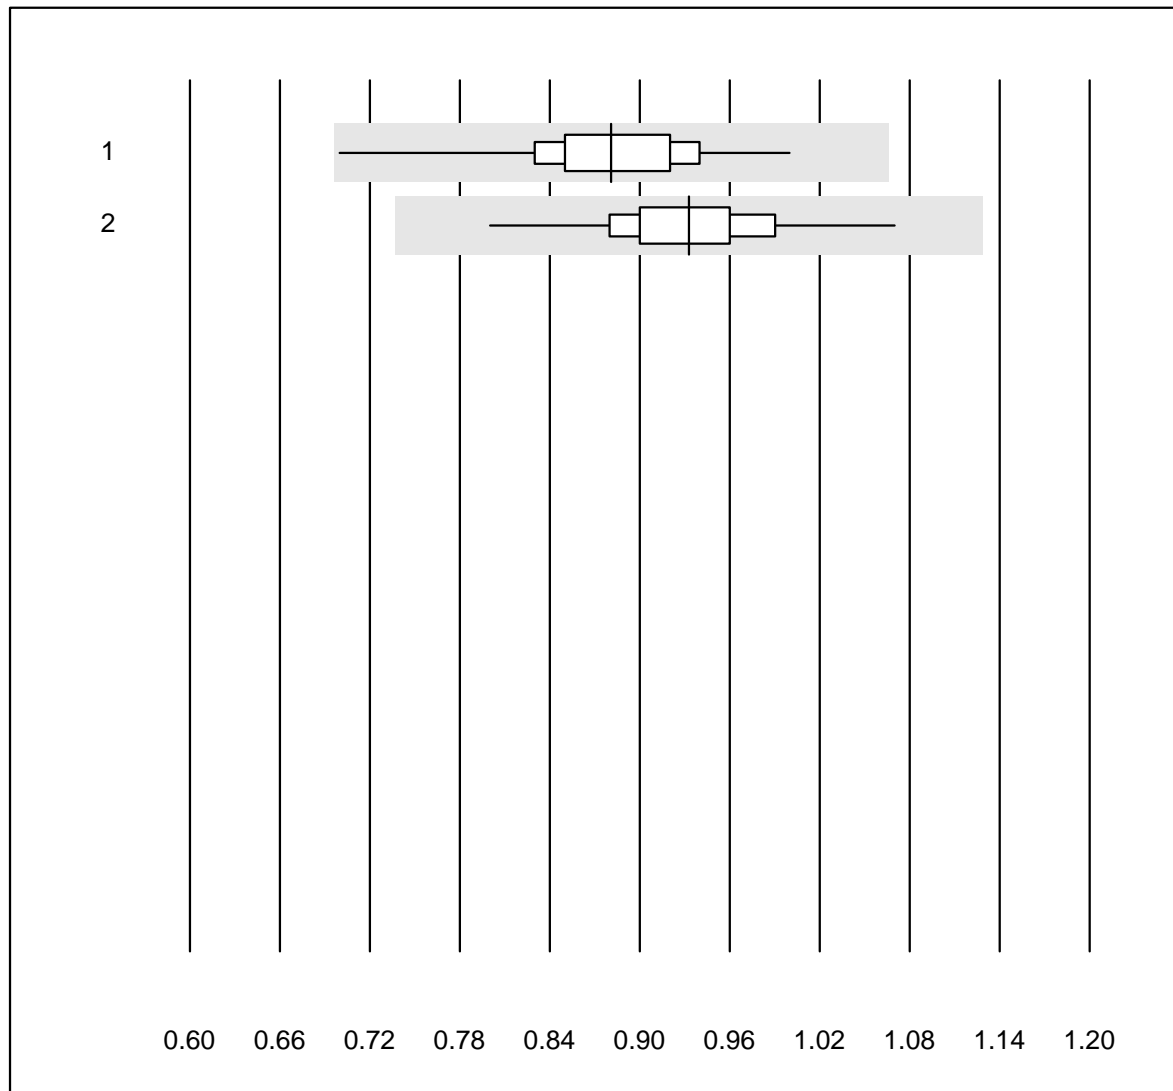


QUALAB Toleranz : 21 %

Cholestérol HDL Af/b101 (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas b101	122	94.3	0.0	5.7	0.88	5.9	e
2 Afinion	425	94.1	0.0	5.9	0.93	4.6	e

Triglycerides Af/b101

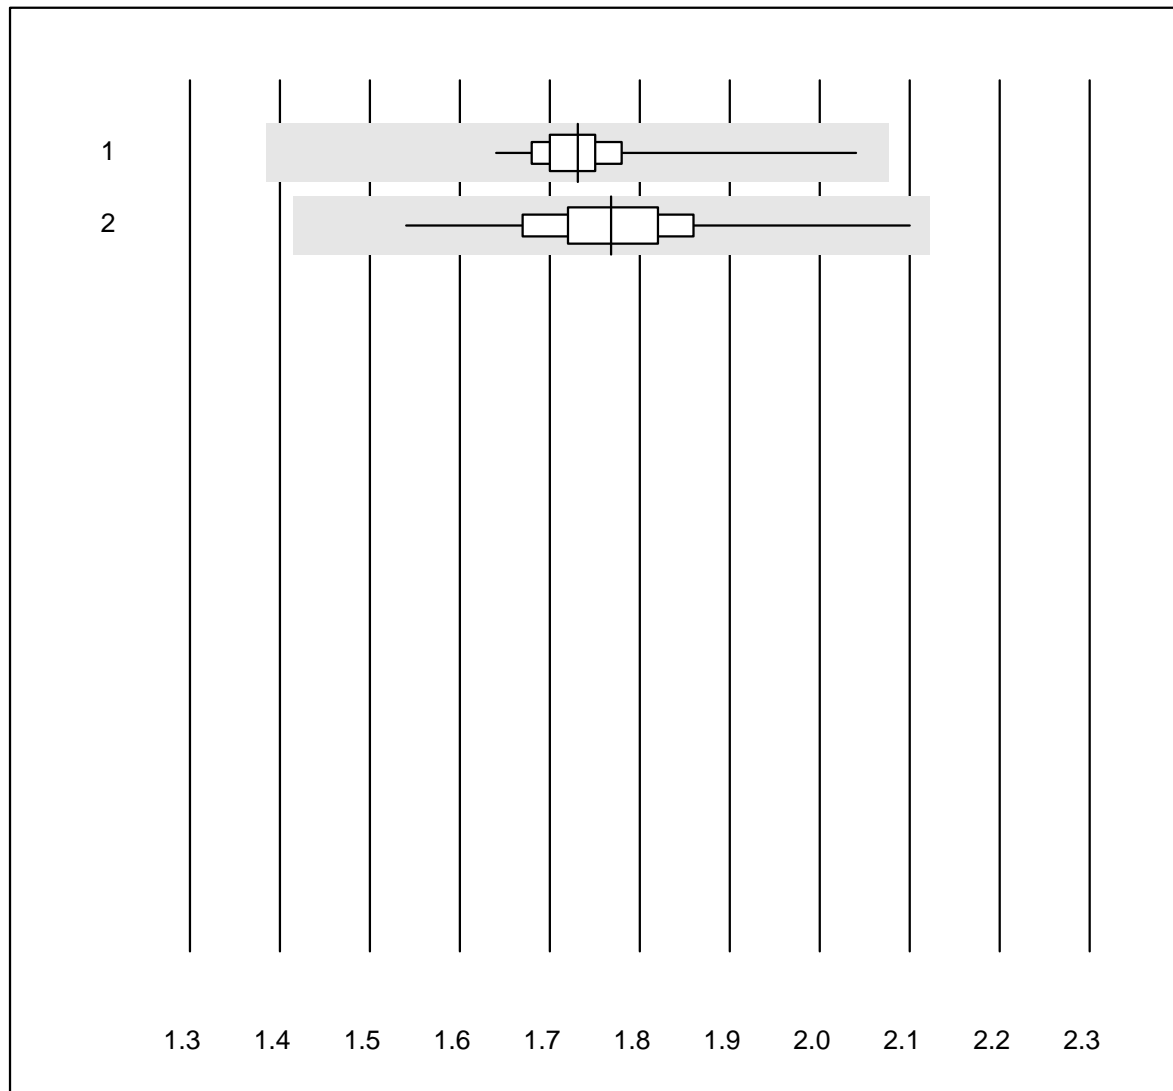


QUALAB Toleranz : 20 %

Triglycerides Af/b101 (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas b101	120	97.5	0.0	2.5	1.73	2.9	e
2 Afinion	424	100.0	0.0	0.0	1.77	4.5	e

Troponine I S

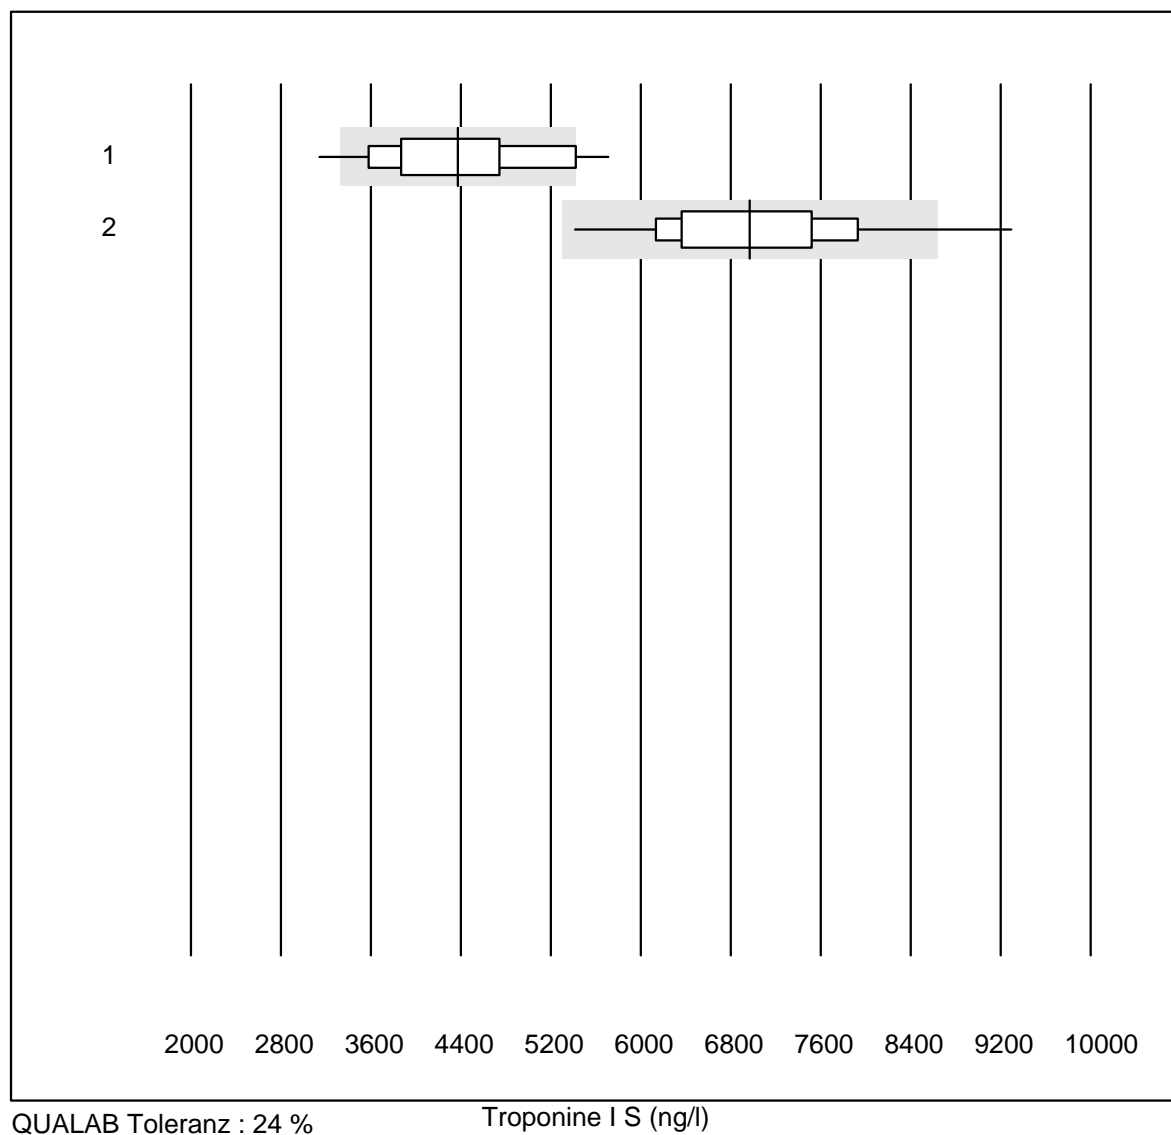


QUALAB Toleranz : 24 %

Troponine I S (ng/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Samsung LABGEO IB10	17	76.4	11.8	11.8	4372.87	16.0	e*
2	AFIAS	116	91.4	3.4	5.2	6970.41	10.9	e

D-Dimères qn S

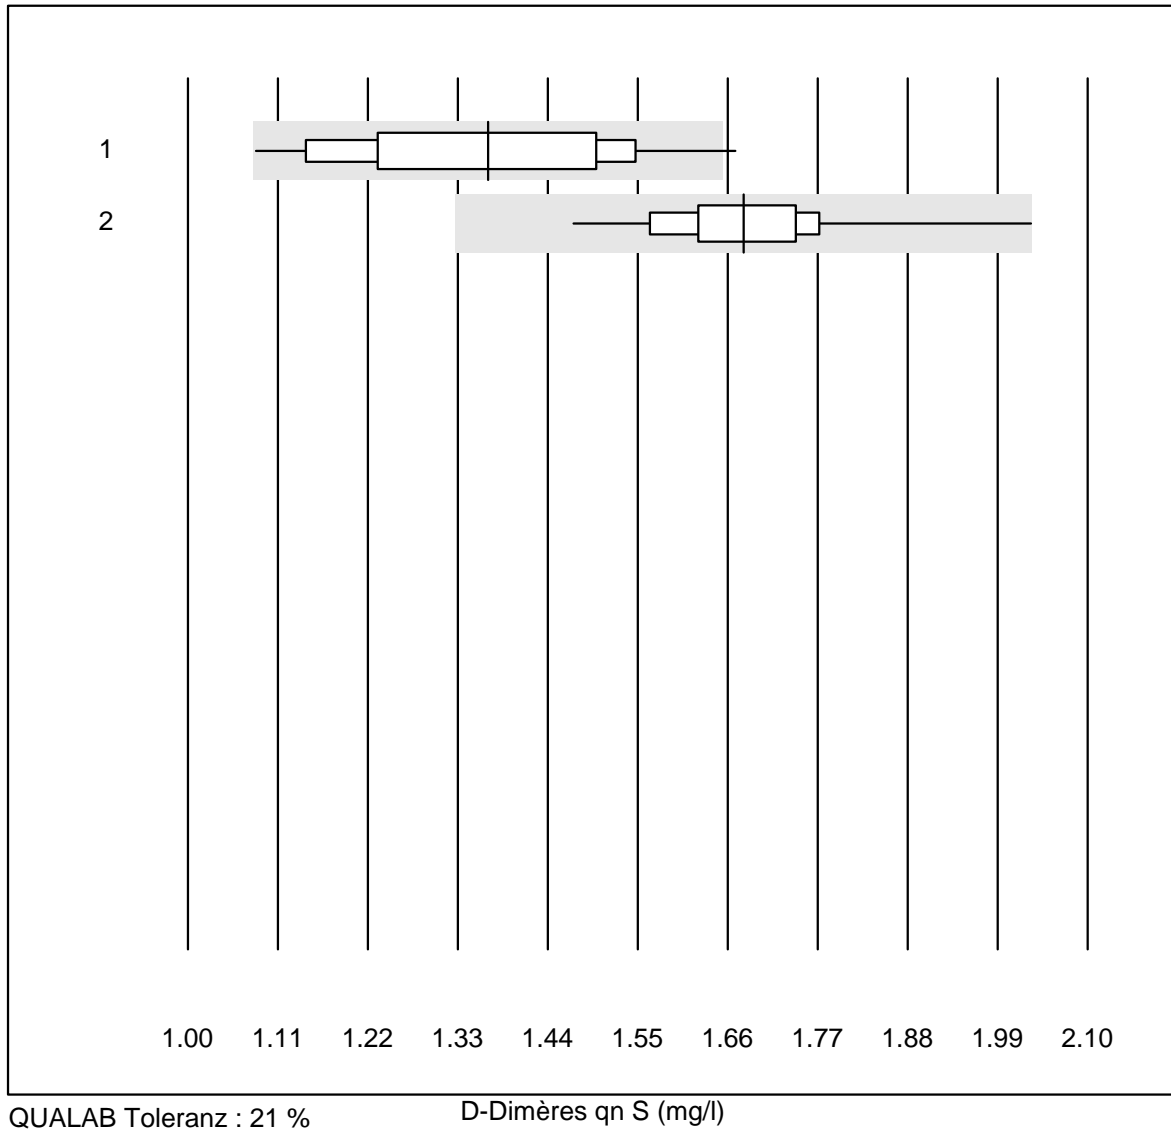


QUALAB Toleranz : 21 %

D-Dimères qn S (mg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Samsung LABGEO IB10	22	86.4	9.1	4.5	1.37	12.8	e*
2	AFIAS	119	92.4	0.0	7.6	1.68	5.2	e

NT-proBNP S

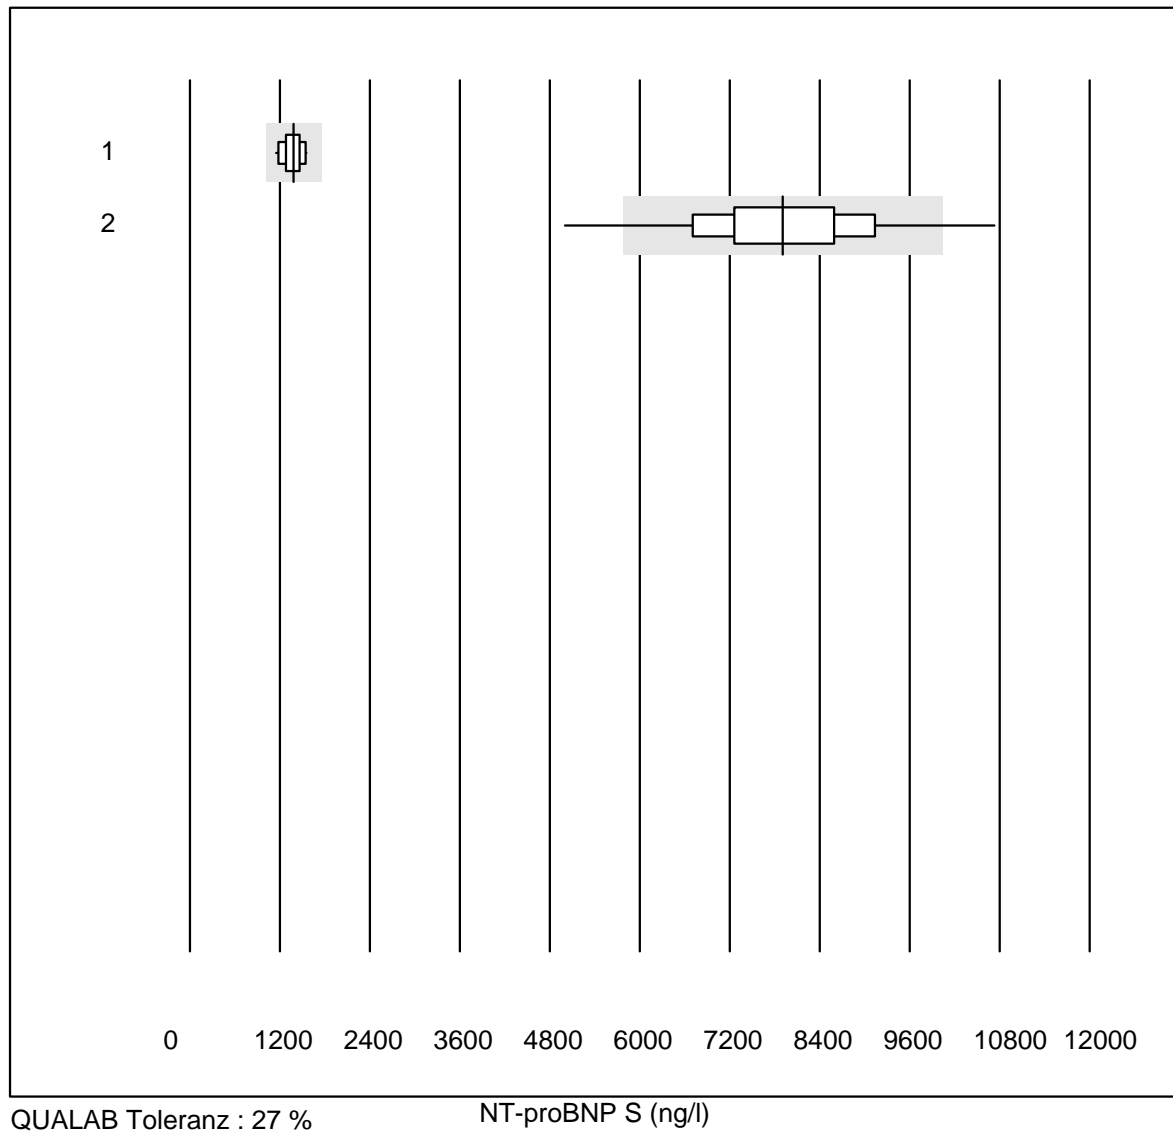


QUALAB Toleranz : 27 %

NT-proBNP S (ng/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Samsung LABGEO IB10	16	81.2	0.0	18.8	1384.9	10.1	e
2	AFIAS	92	83.7	5.4	10.9	7909.5	13.6	e

Homocystein

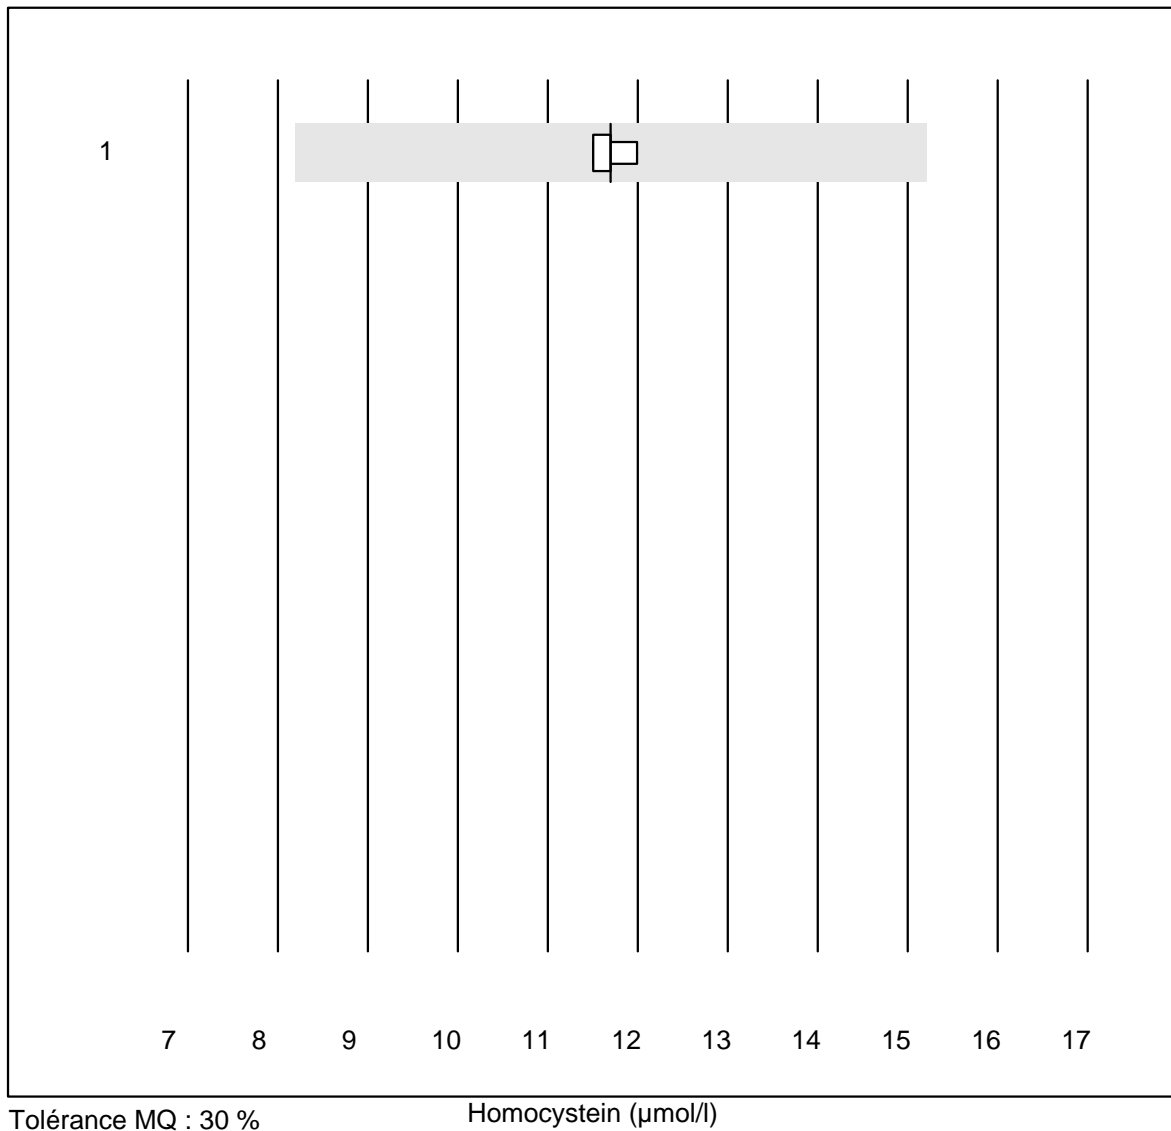


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	11.7	1.7	e

Lipase

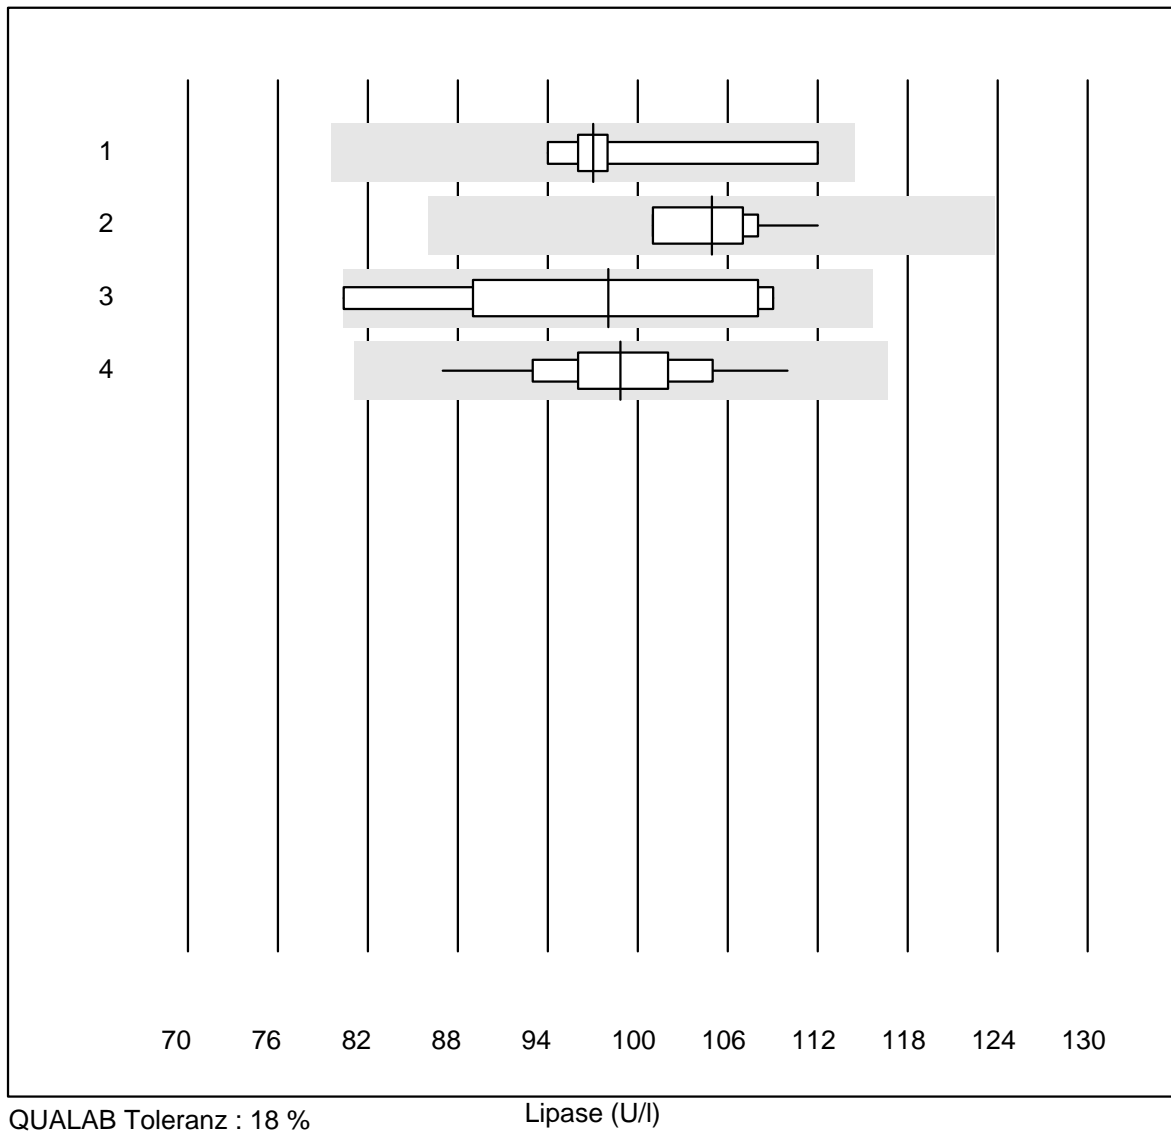


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Architect	5	100.0	0.0	0.0	97.0	7.2	e*
2 Beckman	12	100.0	0.0	0.0	104.9	3.3	e
3 Cobas	11	81.8	9.1	9.1	98.1	10.7	e*
4 Fuji Dri-Chem	128	98.4	0.0	1.6	98.9	4.5	e

Cholinestérase

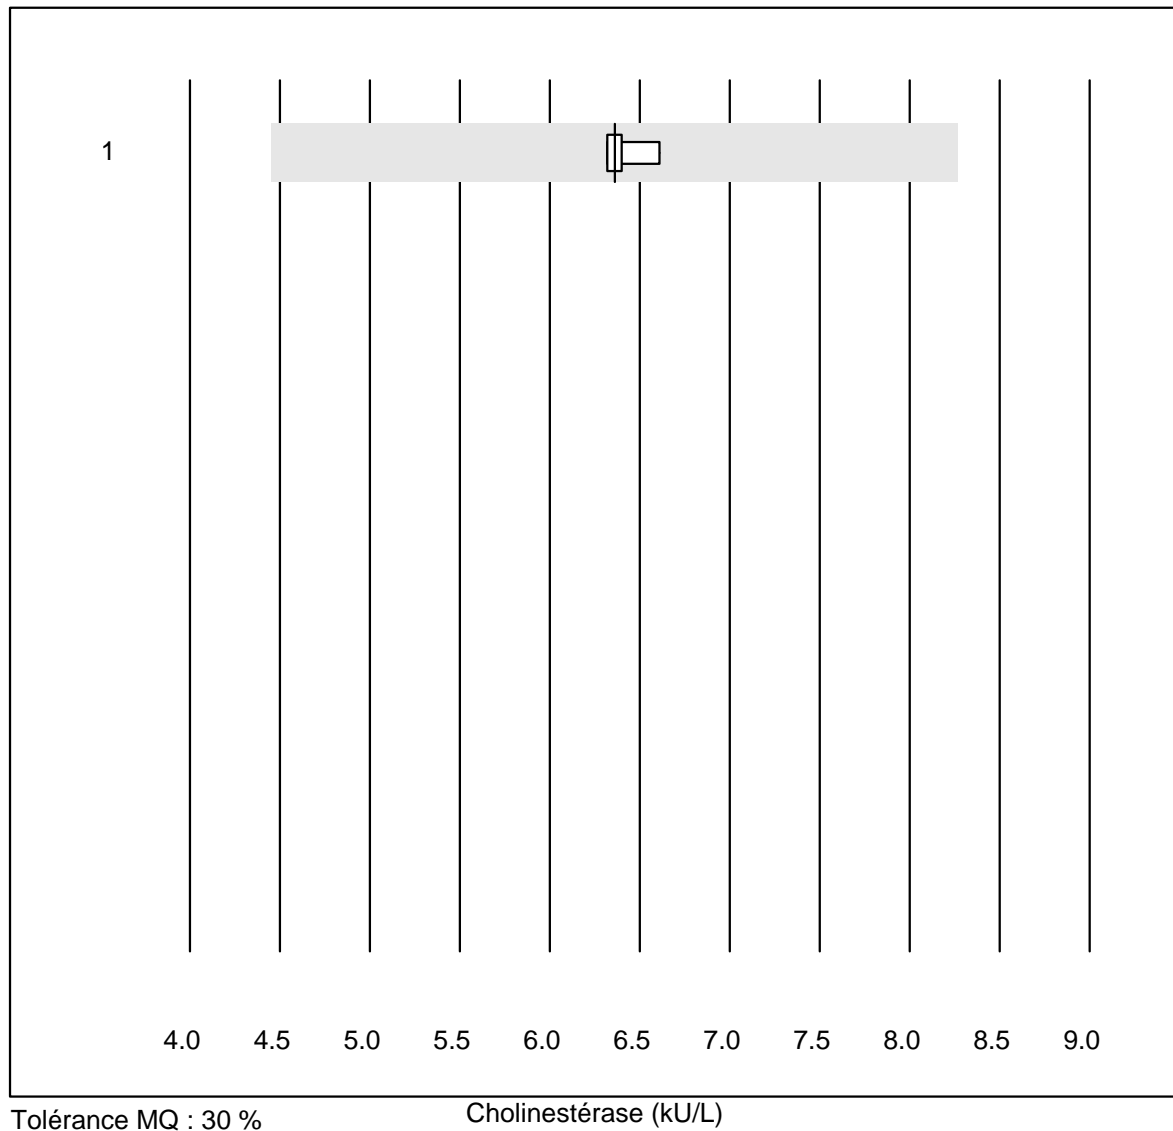

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	6.4	2.1	e

Glucose CSF

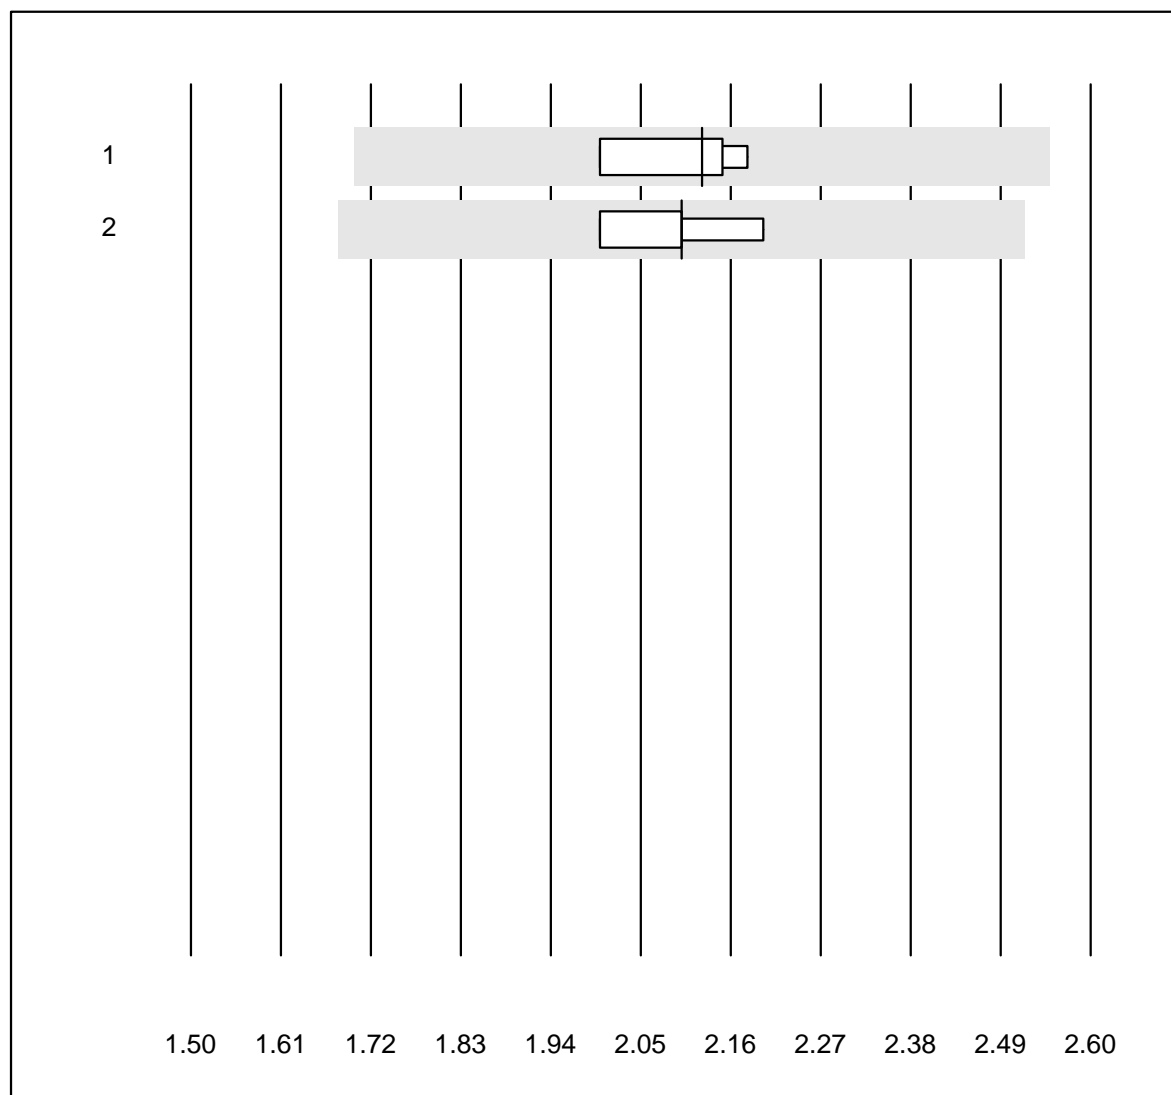


Tolérance MQ : 20 %

Glucose CSF (mmol/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	2.13	3.7	e
2 Autres méthodes	8	100.0	0.0	0.0	2.10	3.4	e

Lactate CSF

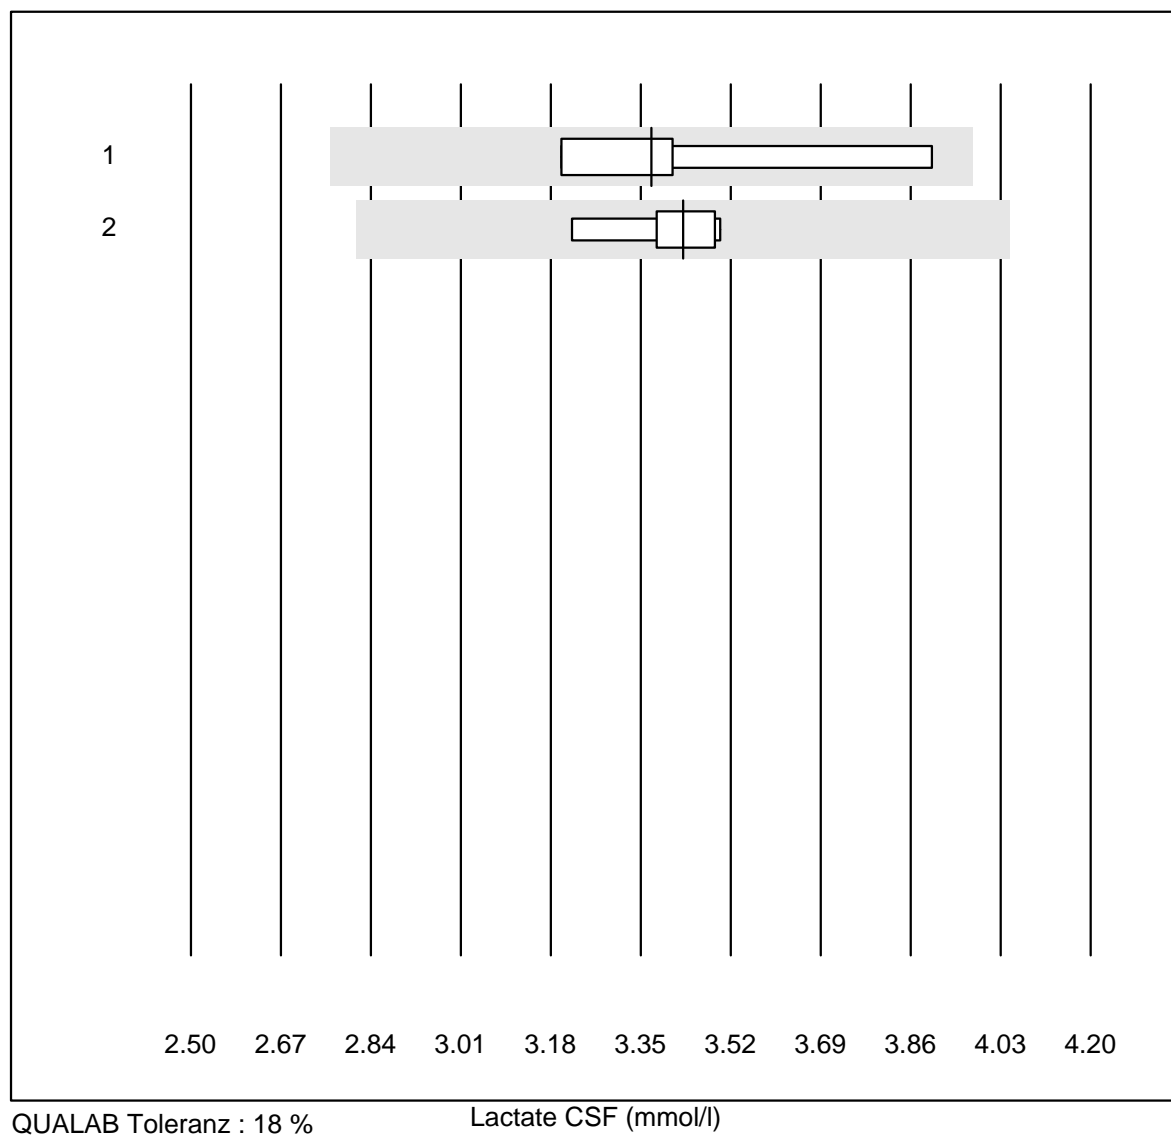


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	3.37	8.8	e*
2 Autres méthodes	7	100.0	0.0	0.0	3.43	2.7	e

Protéine CSF

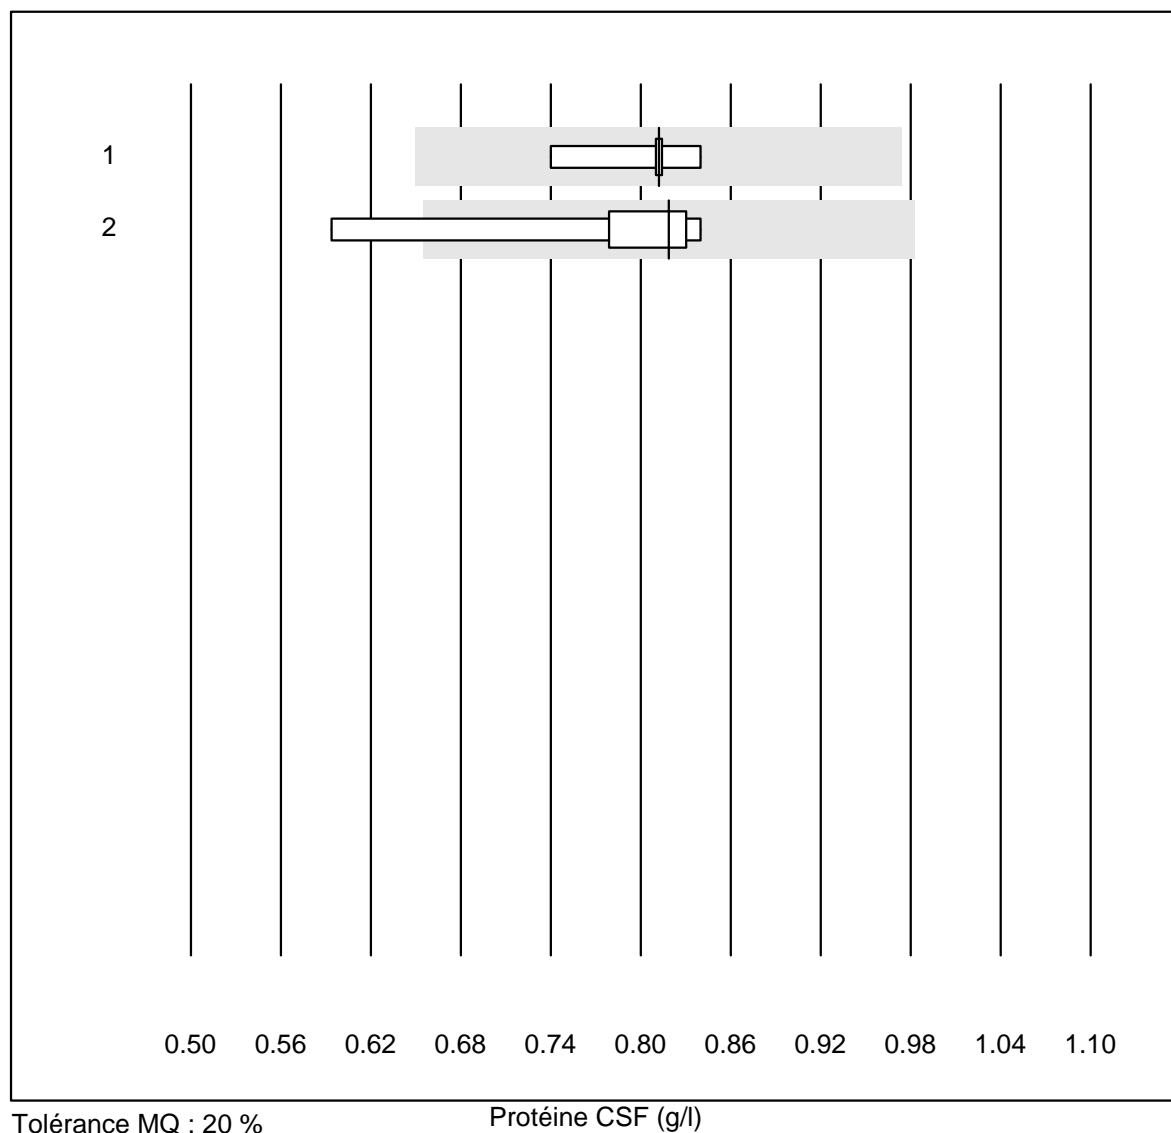

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	0.81	4.7	e
2 Autres méthodes	6	83.3	16.7	0.0	0.82	12.0	e*

Albumine CSF

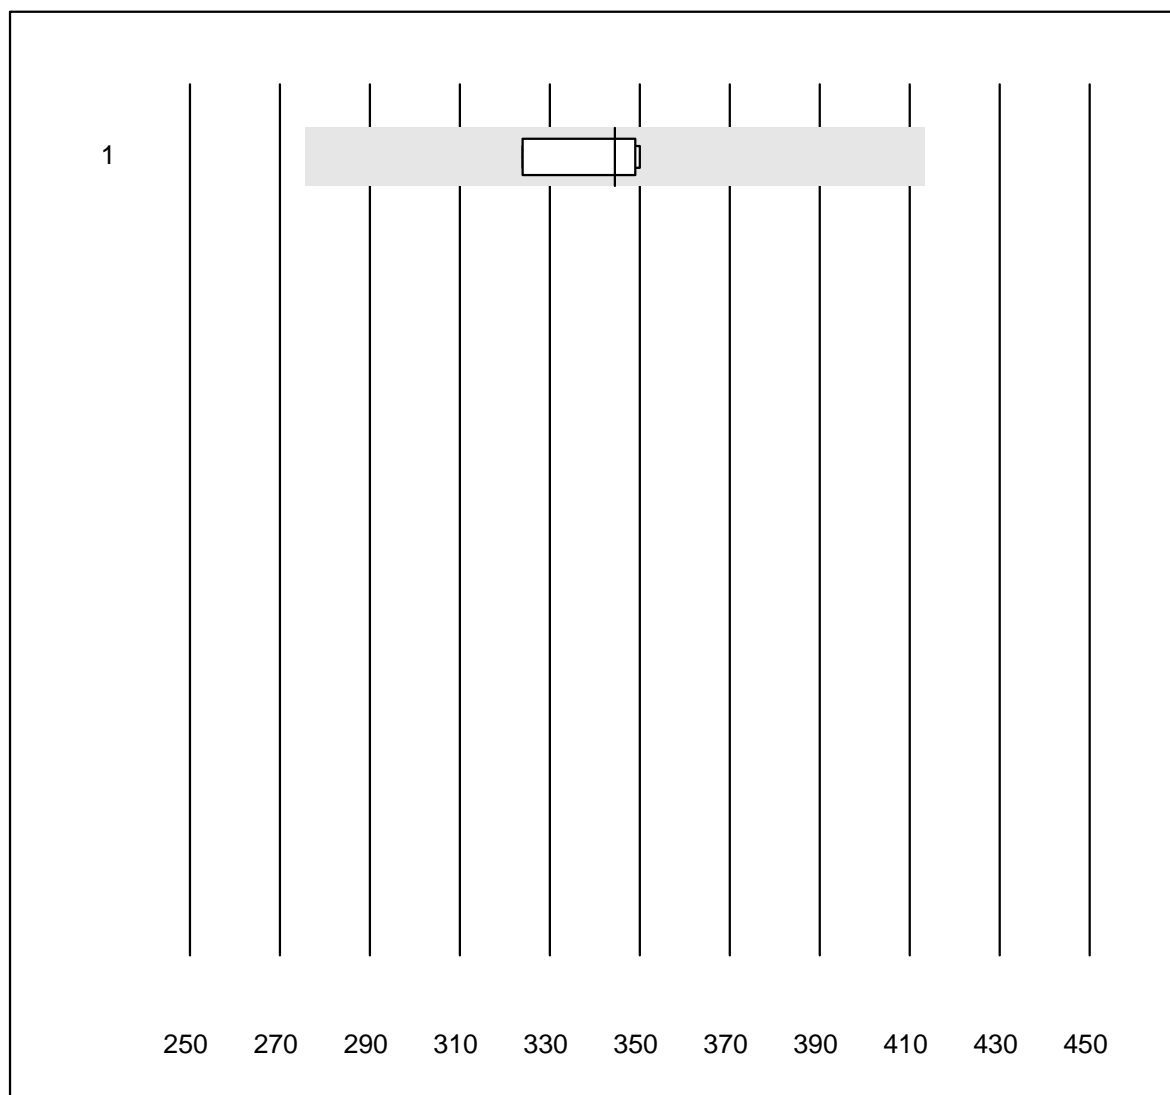


Tolérance MQ : 20 %

Albumine CSF (mg/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas	4	100.0	0.0	0.0	344.50	3.5	e

CDT

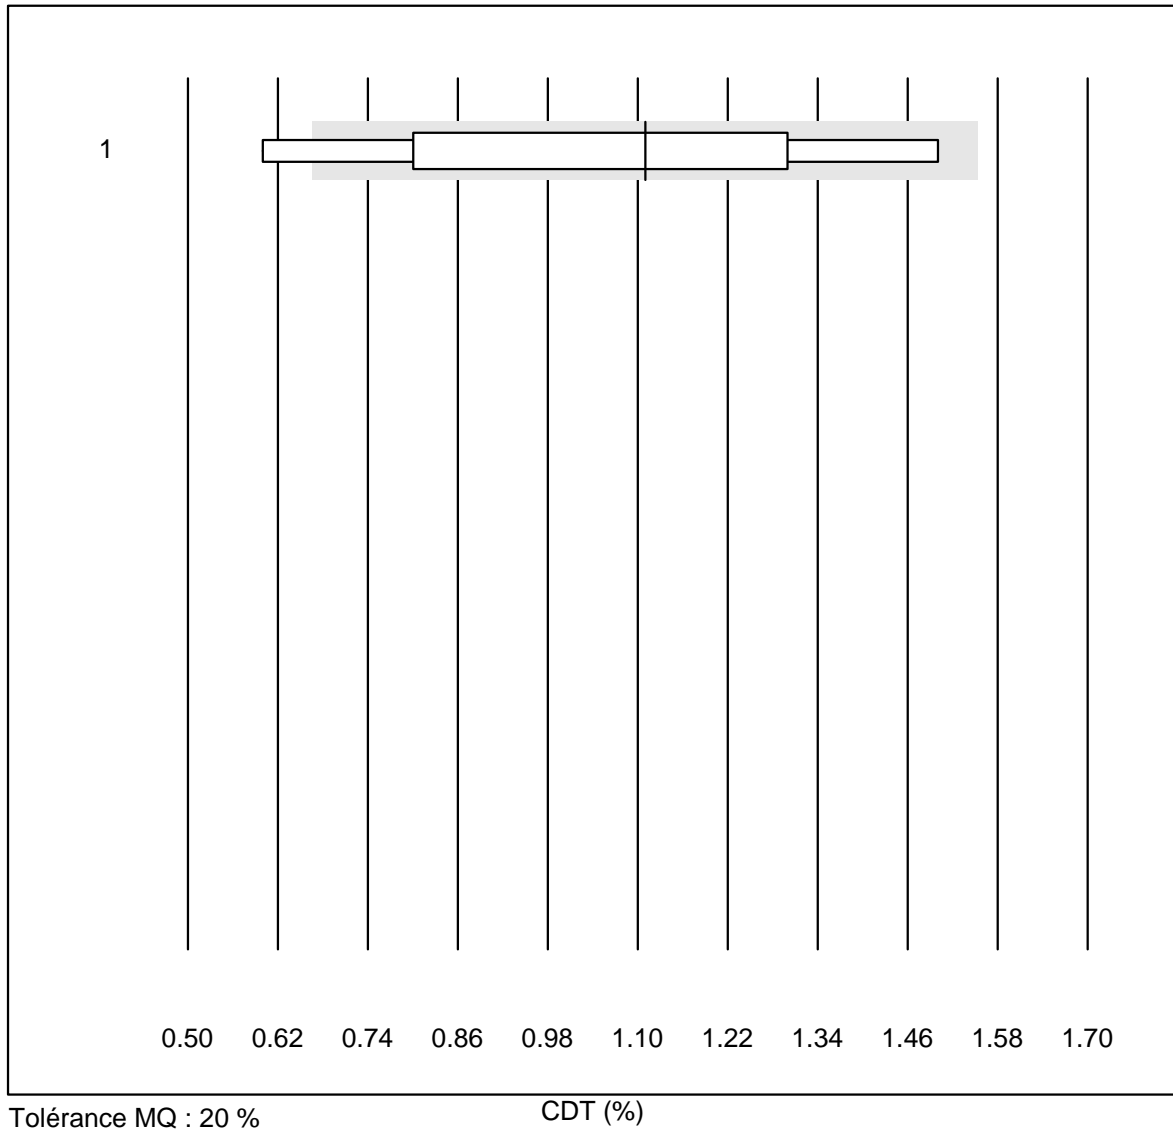


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	6	83.3	16.7	0.0	1.1	30.5	a

Tacrolimus

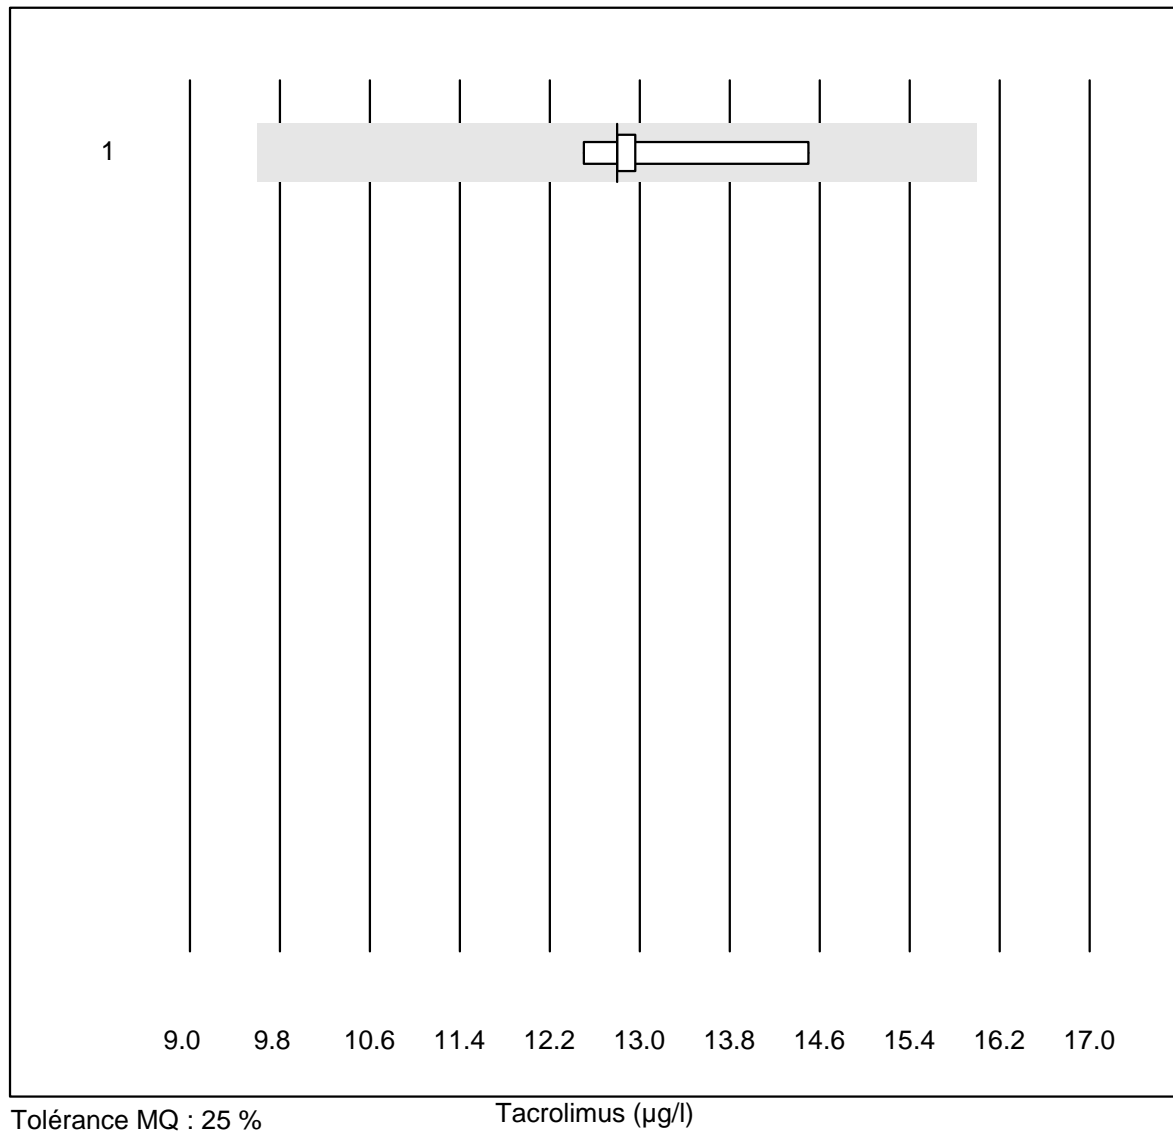

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	12.8	6.1	e

Totalprotein E

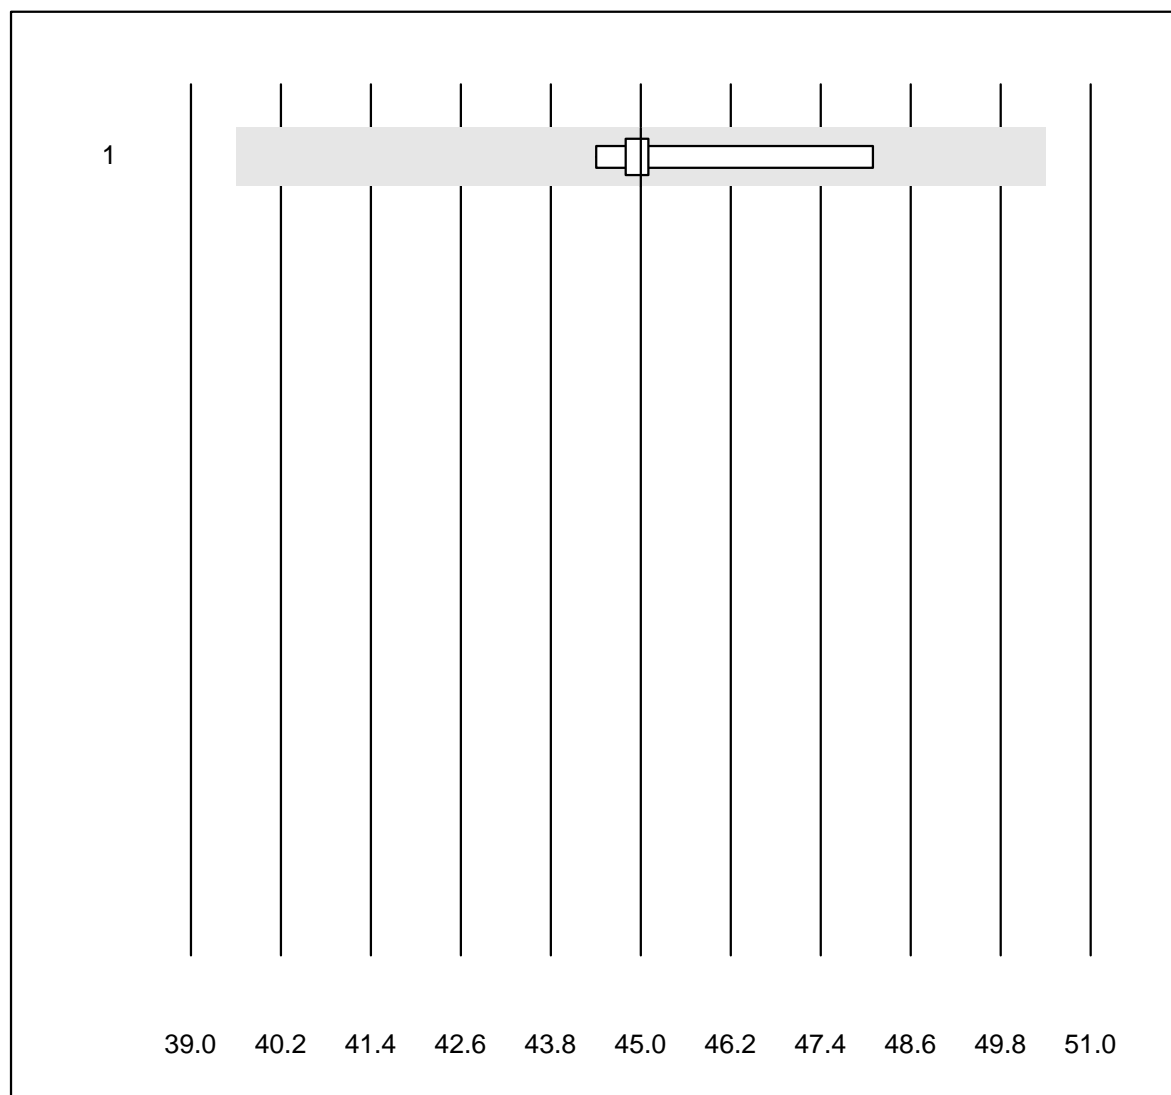


Tolérance MQ : 12 %

Totalprotein E (g/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	45.0	3.3	e*

Albumin E

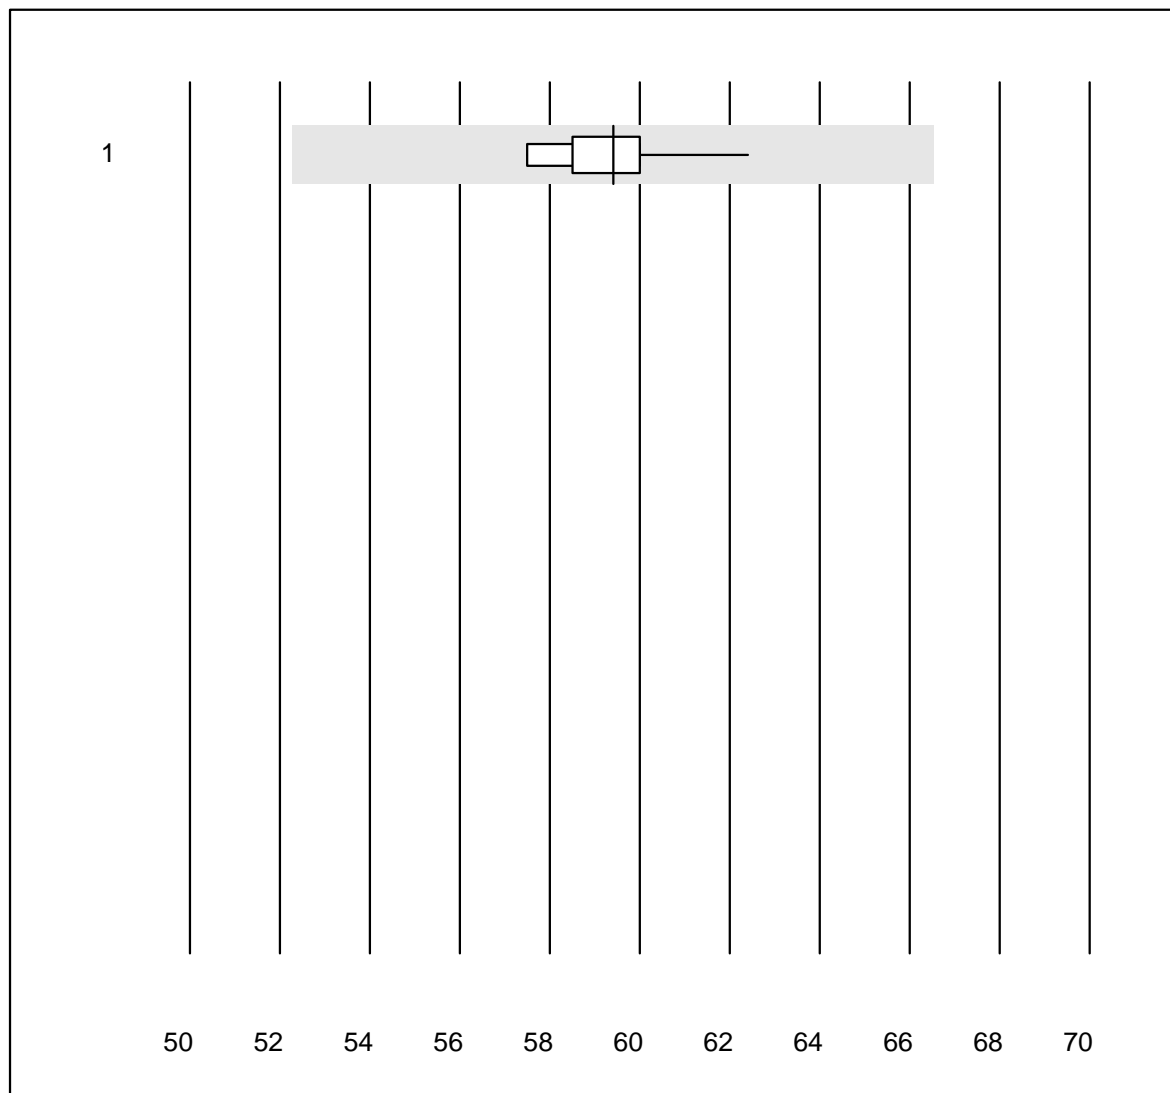


Tolérance MQ : 12 %

Albumin E (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Elektrophorese	10	100.0	0.0	0.0	59.4	2.4	e

alpha-1-Globuline

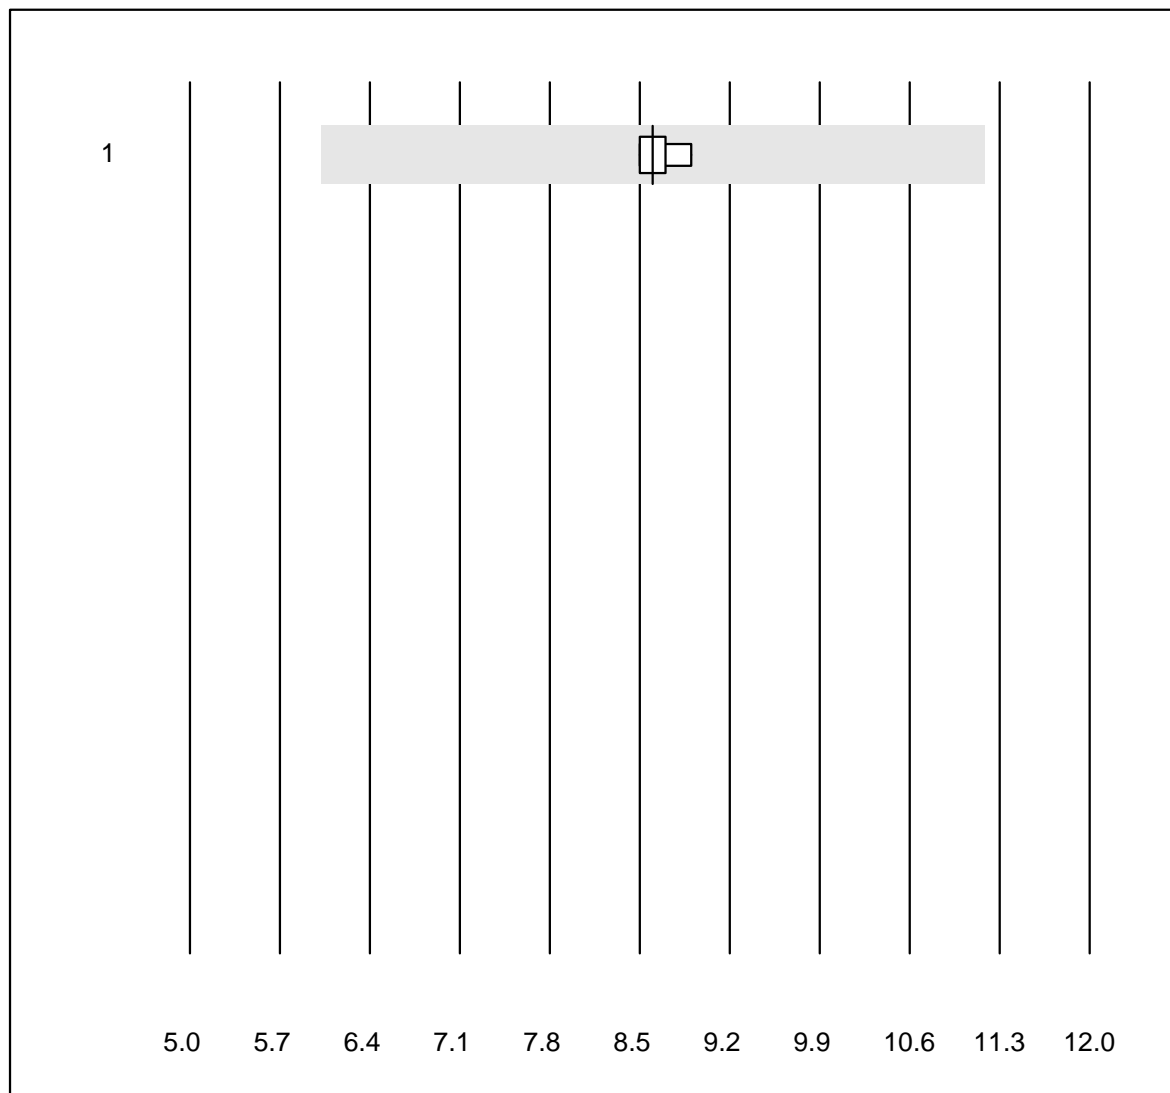


Tolérance MQ : 30 %

alpha-1-Globuline (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Kapillar-Elektrophor	7	100.0	0.0	0.0	8.6	1.7	e

alpha-2-Globuline

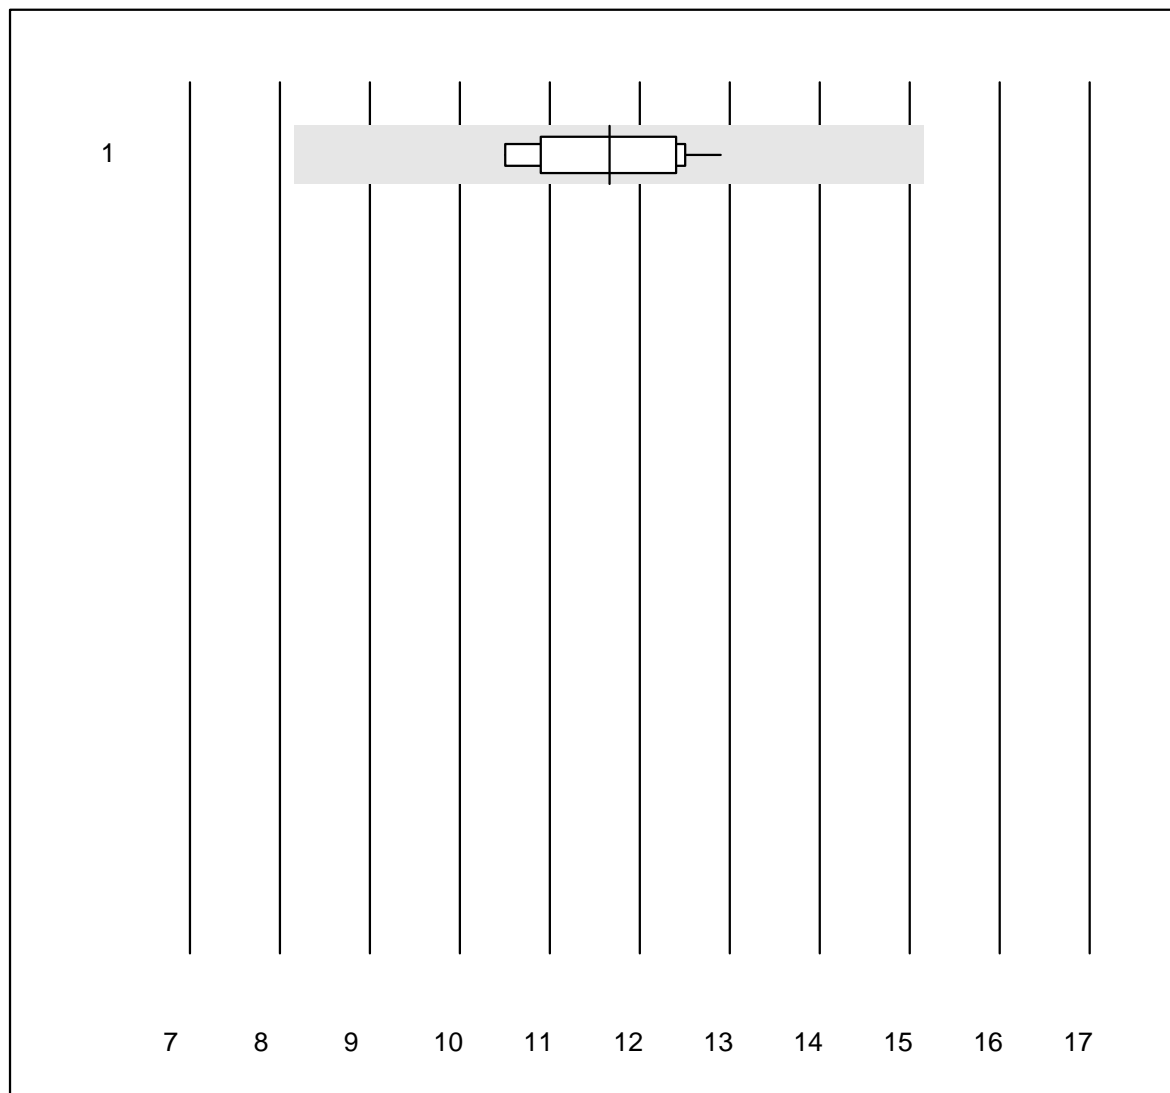


Tolérance MQ : 30 %

alpha-2-Globuline (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Elektrophorese	10	100.0	0.0	0.0	11.7	7.3	e

beta-Globuline

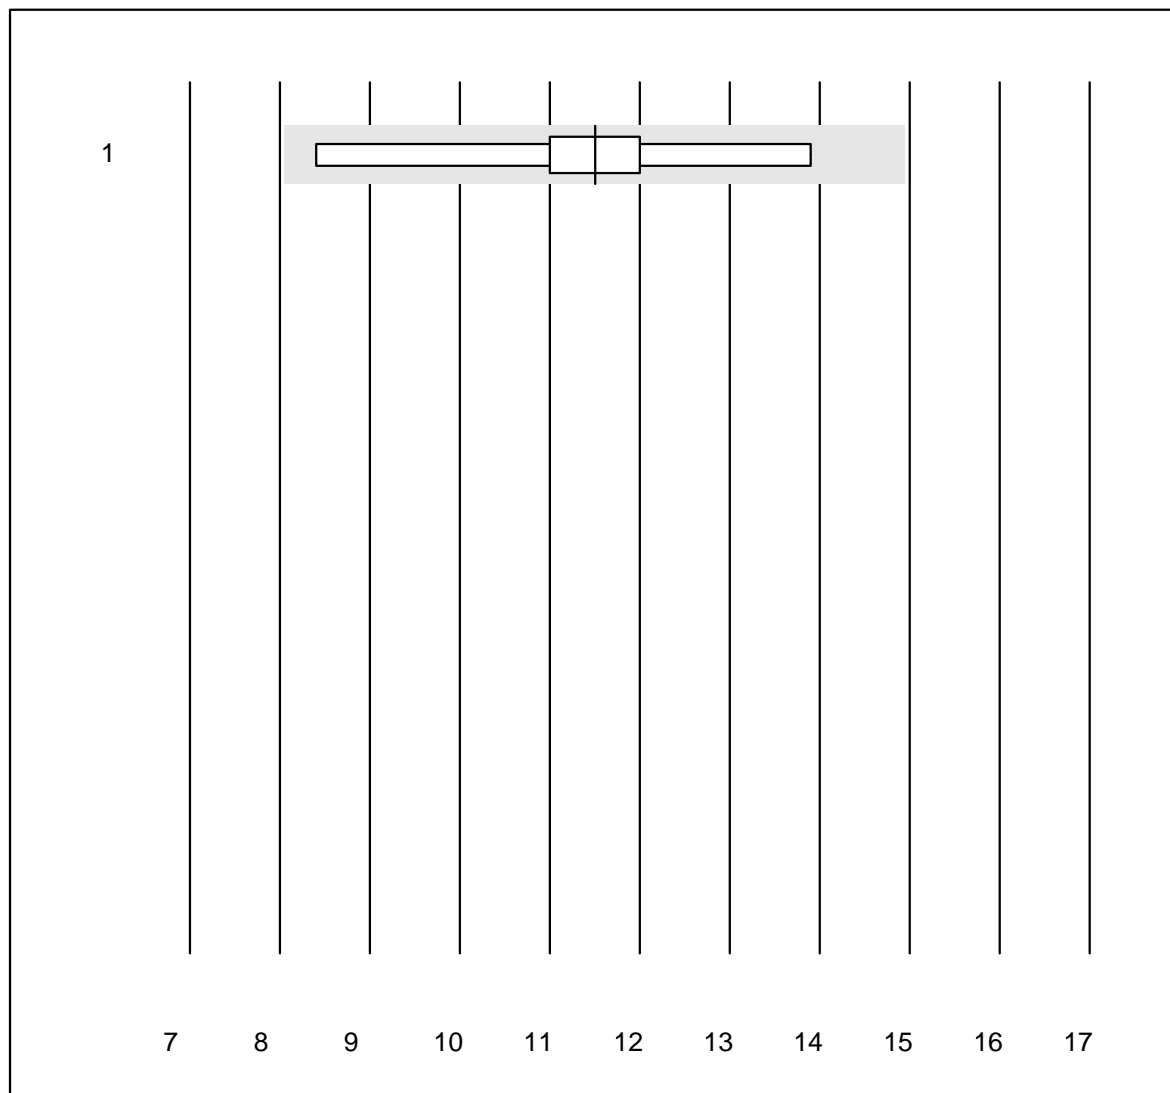


Tolérance MQ : 30 %

beta-Globuline (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Elektrophorese	9	100.0	0.0	0.0	11.5	12.9	e*

gamma-Globuline

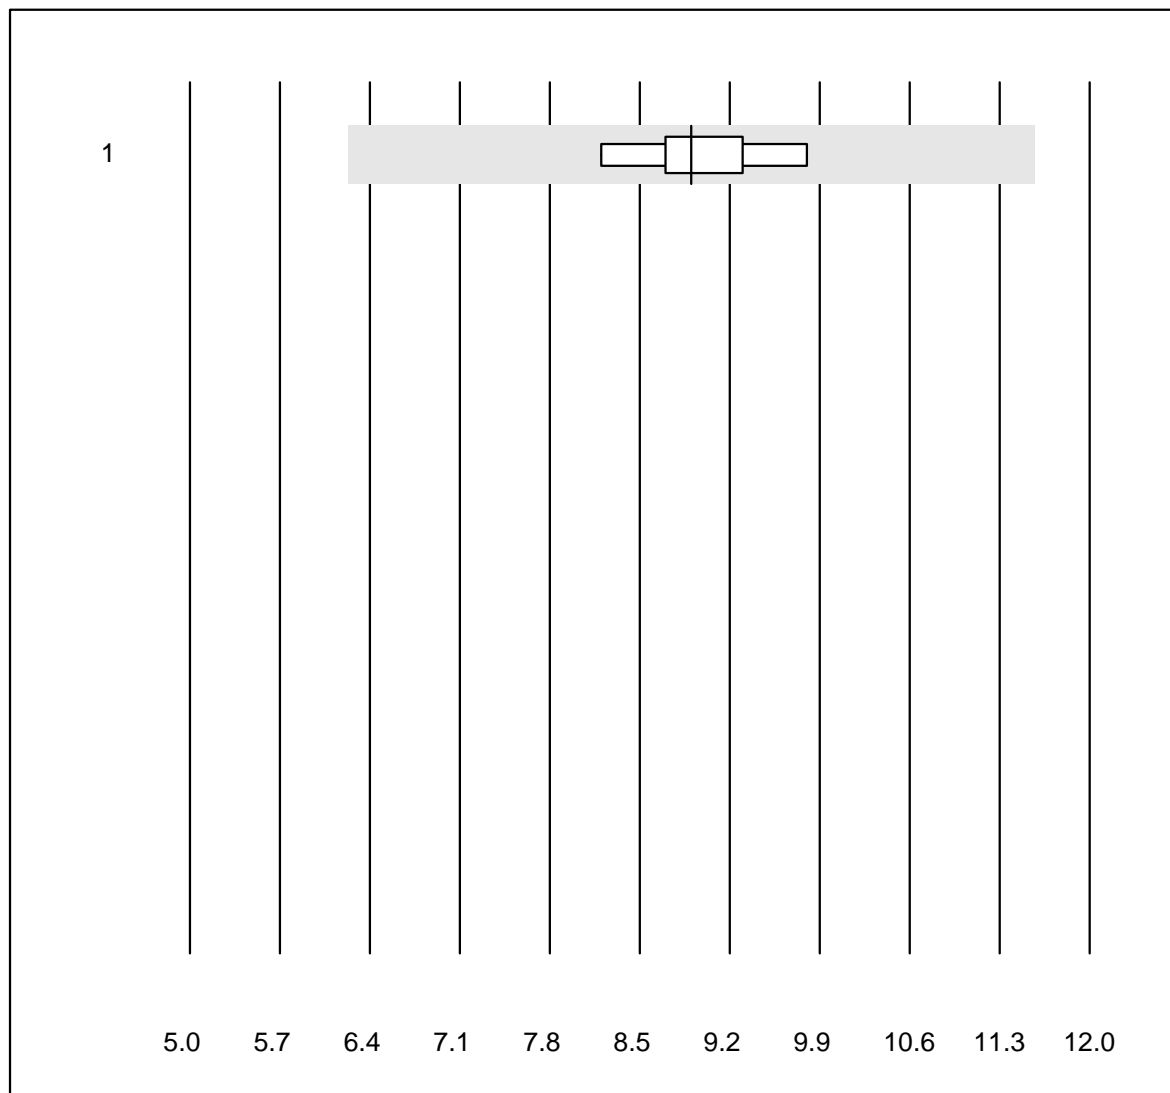


Tolérance MQ : 30 %

gamma-Globuline (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Elektrophorese	9	100.0	0.0	0.0	8.9	5.6	e

Immundefixation

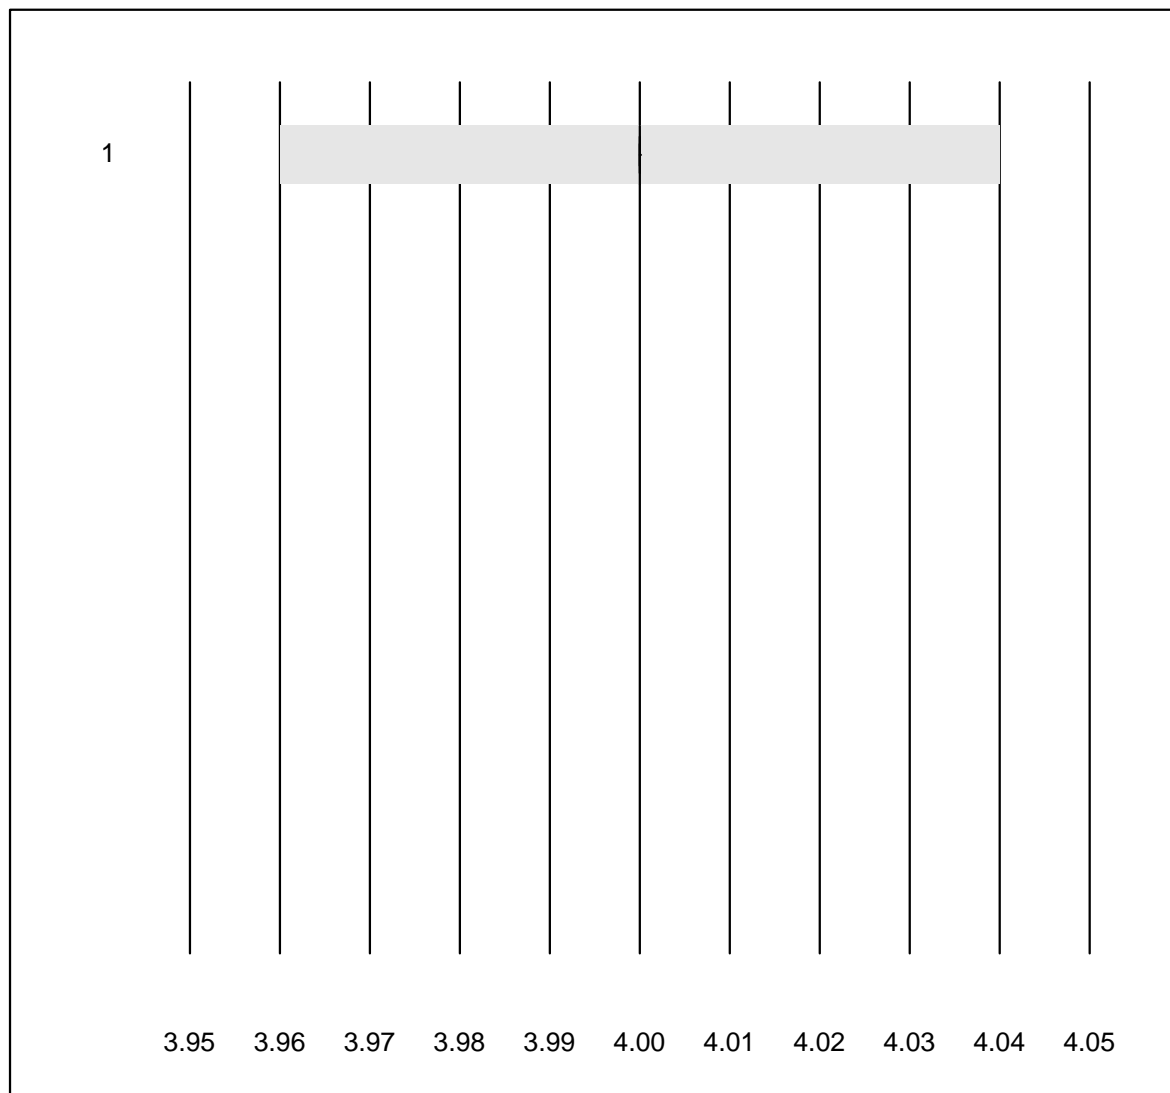


Tolérance MQ : 1 %

Immundefixation (Code)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Interpretation	11	100.0	0.0	0.0	4	0.0	e

Folates érythrocytaires

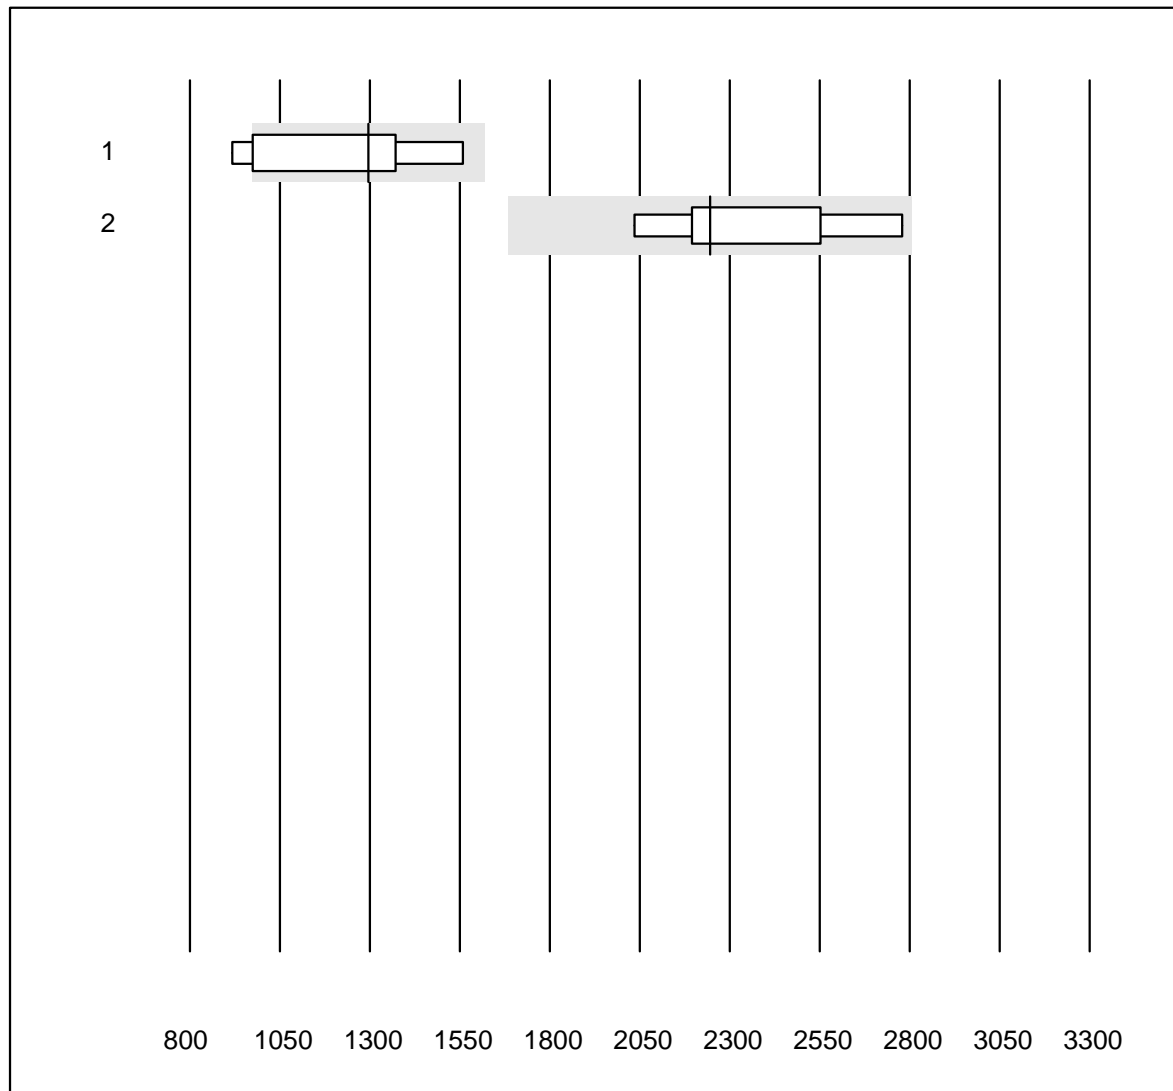


Tolérance MQ : 25 %

Folates érythrocytaires (nmol/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Architect	7	71.4	14.3	14.3	1296	21.6	e*
2 Cobas	6	100.0	0.0	0.0	2245	11.6	e*

Gallensäure

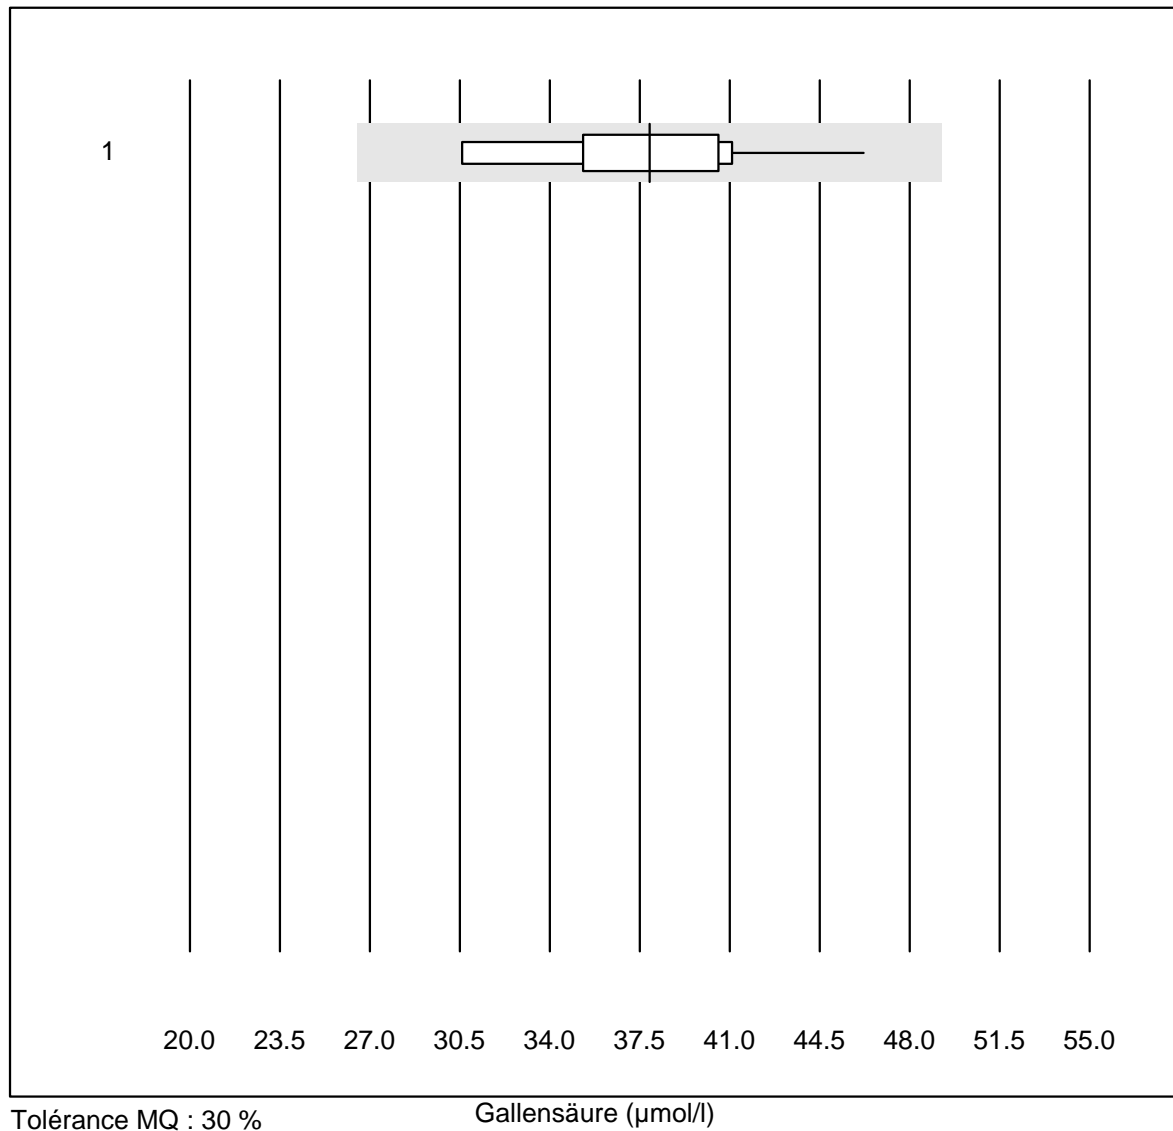

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	10	100.0	0.0	0.0	37.9	12.4	e*

BNP

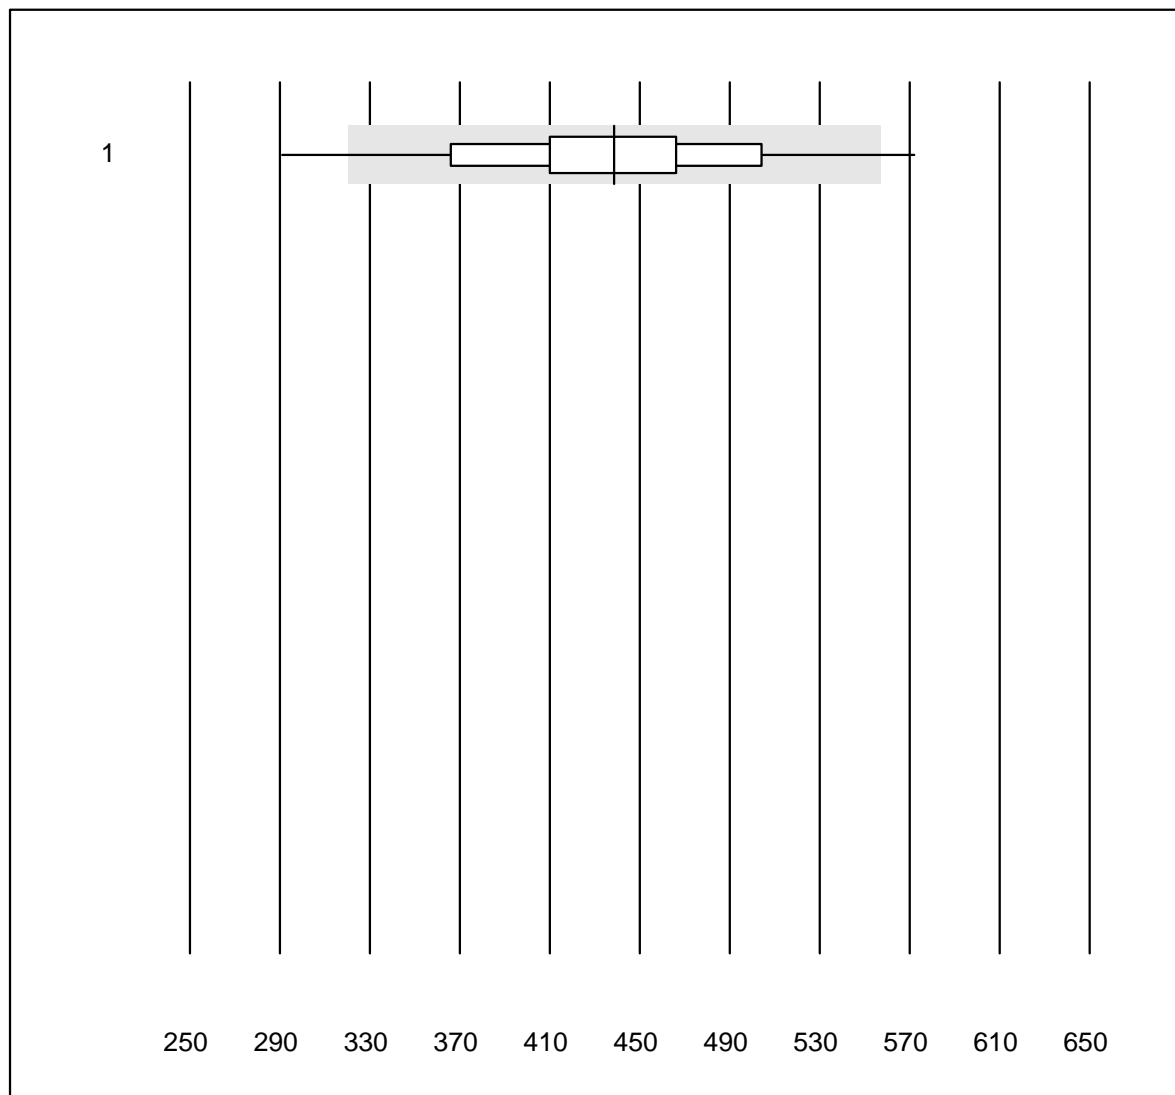


QUALAB Toleranz : 27 %

BNP (ng/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Triage	28	89.3	7.1	3.6	438.5	12.6	e

Troponin Triage

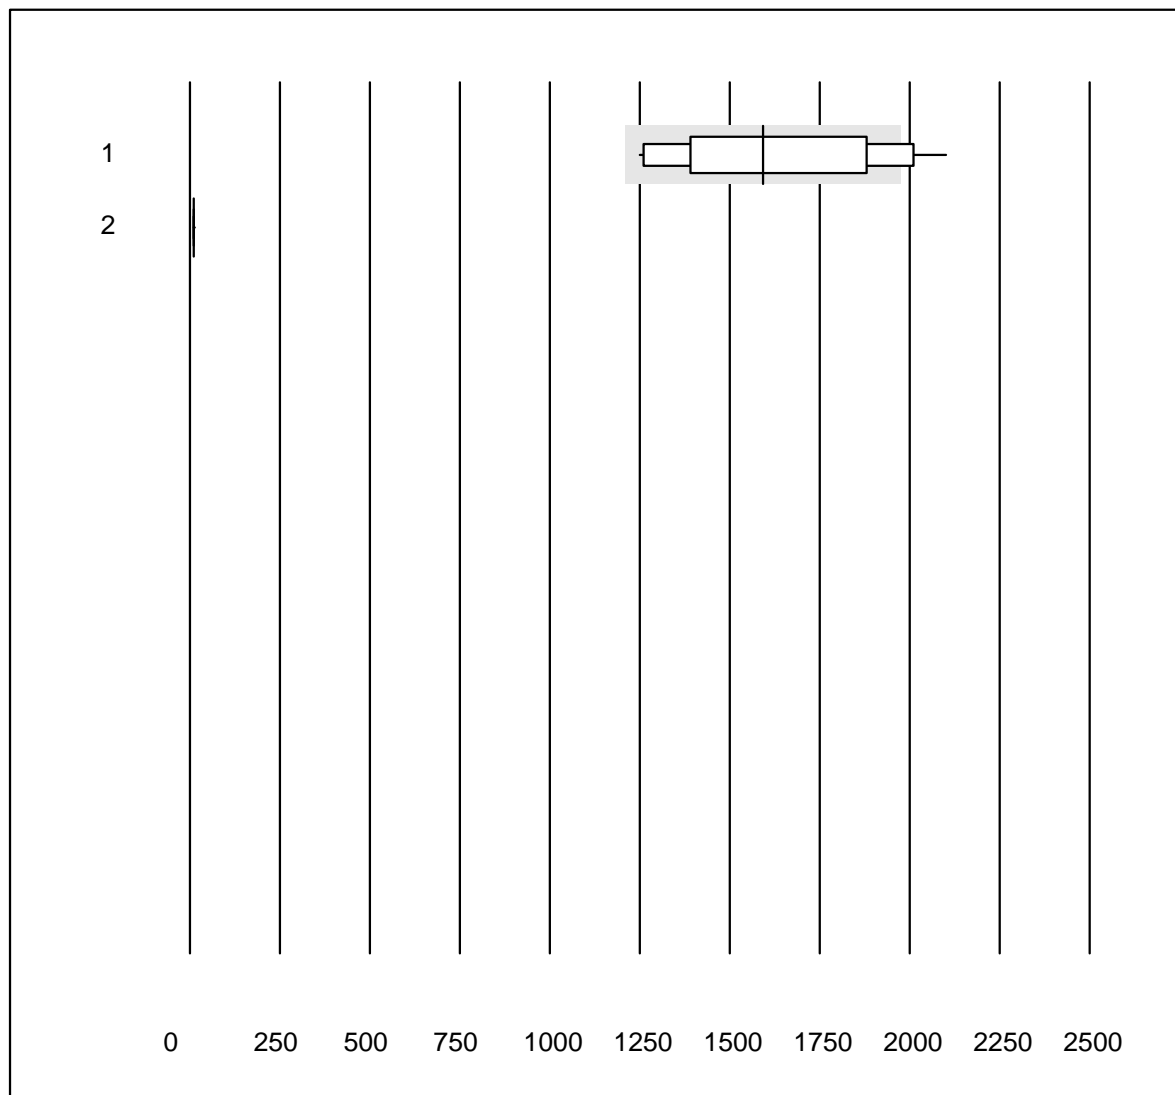


QUALAB Toleranz : 24 %

Troponin Triage (ng/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Triage SOB/Cardiac	15	73.4	13.3	13.3	1593.08	19.3	e*
2	Triage Next Gen	27	66.7	0.0	33.3	10.00	0.0	a

NT-pro BNP

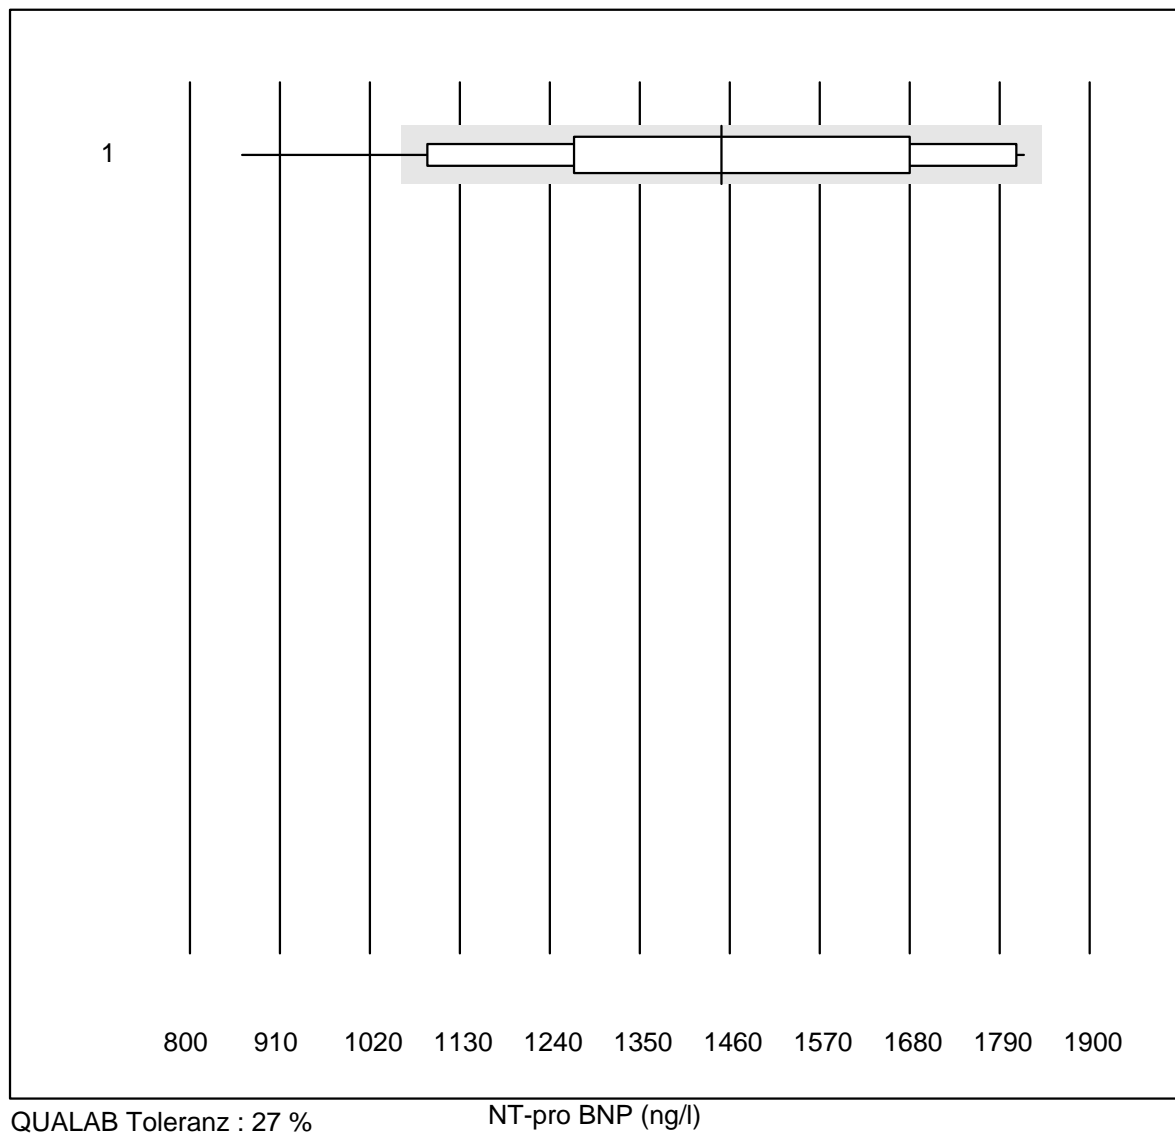

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Triage	12	91.7	8.3	0.0	1450	20.7	e*

D-Dimere Triage

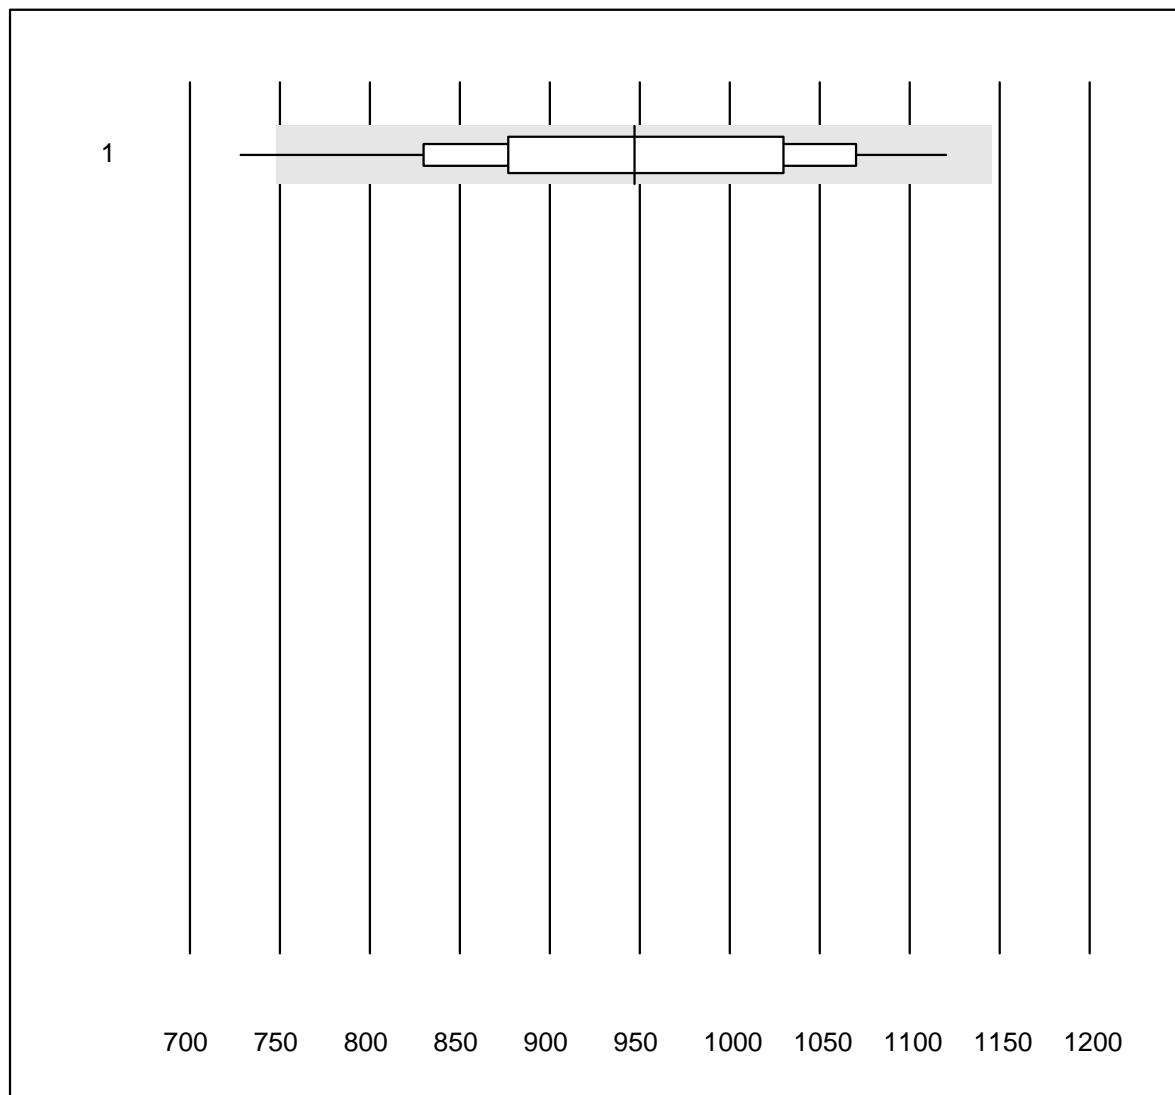


QUALAB Toleranz : 21 %

D-Dimere Triage (ng/ml)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Triage	42	95.2	2.4	2.4	946.93	10.5	e

CK-MB Triage

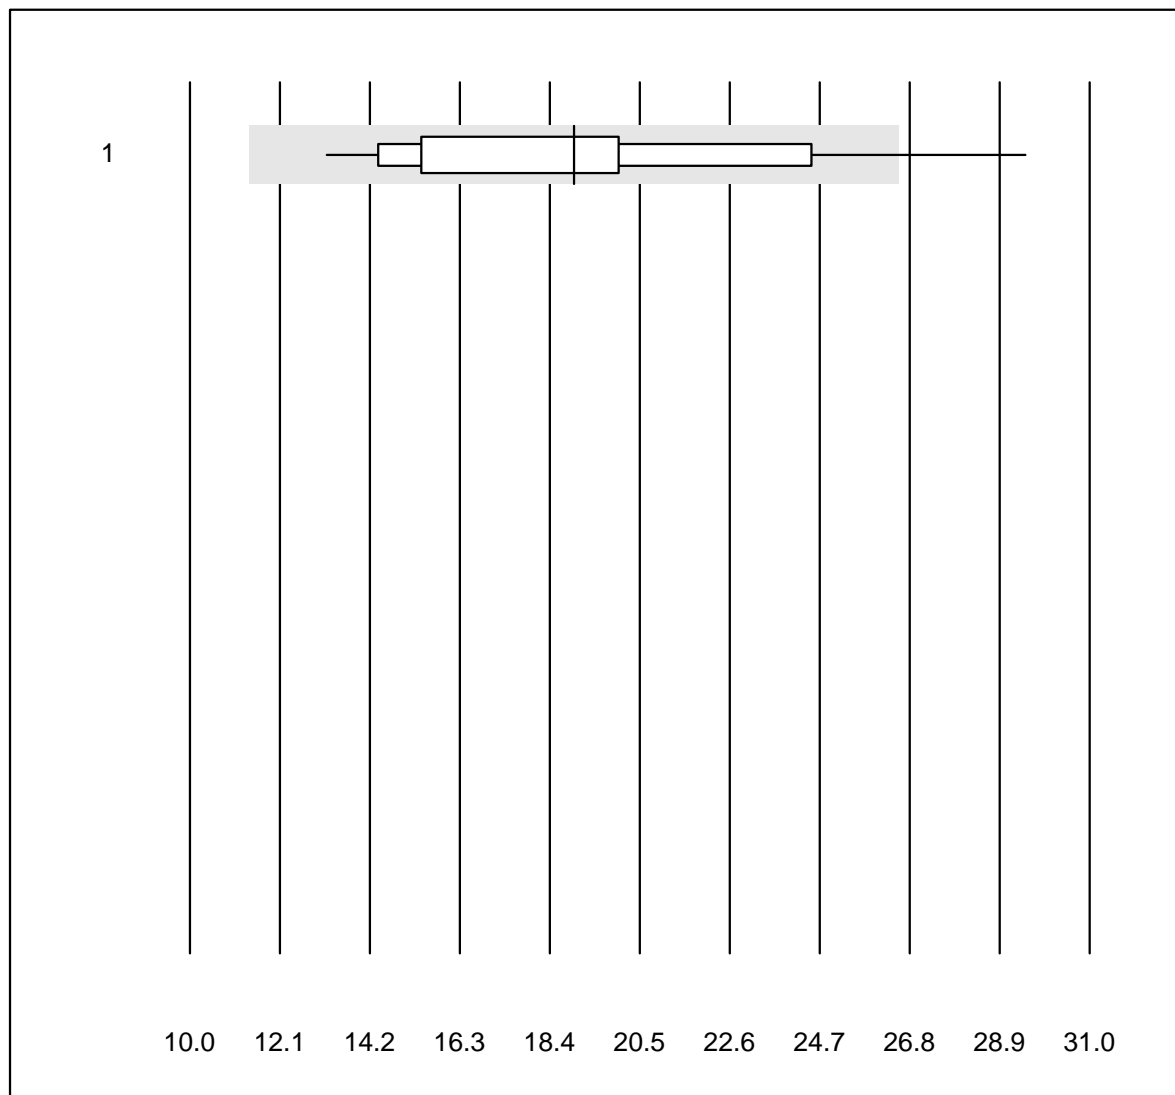


Tolérance MQ : 40 %

CK-MB Triage (µg/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Triage	14	92.9	7.1	0.0	19.0	23.0	e*

Myoglobin Triage

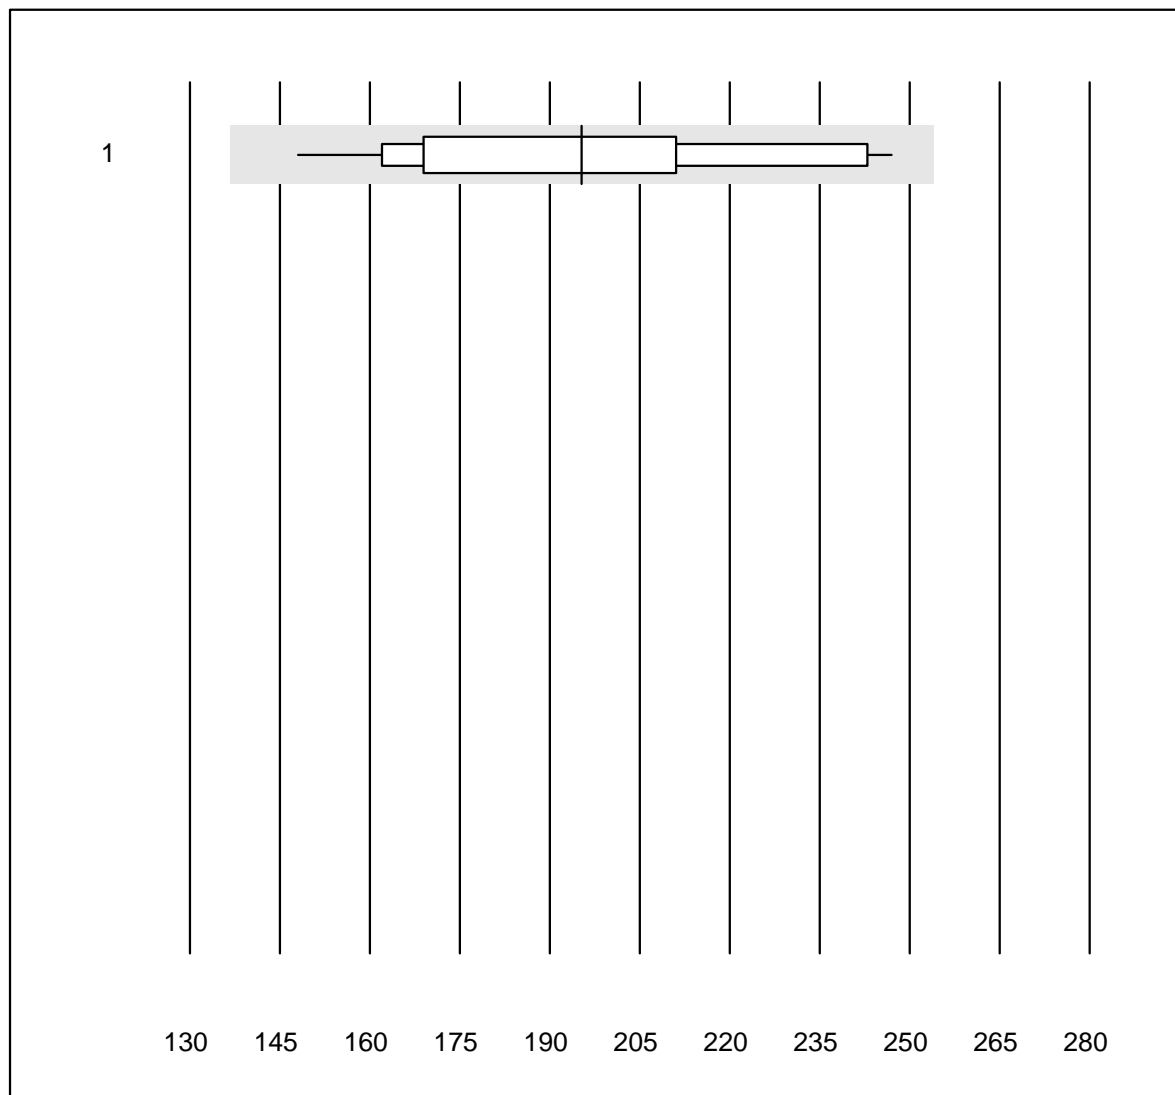


QUALAB Toleranz : 30 %

Myoglobin Triage (µg/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Triage	12	100.0	0.0	0.0	195.3	16.0	e*

25-OH Vitamin D

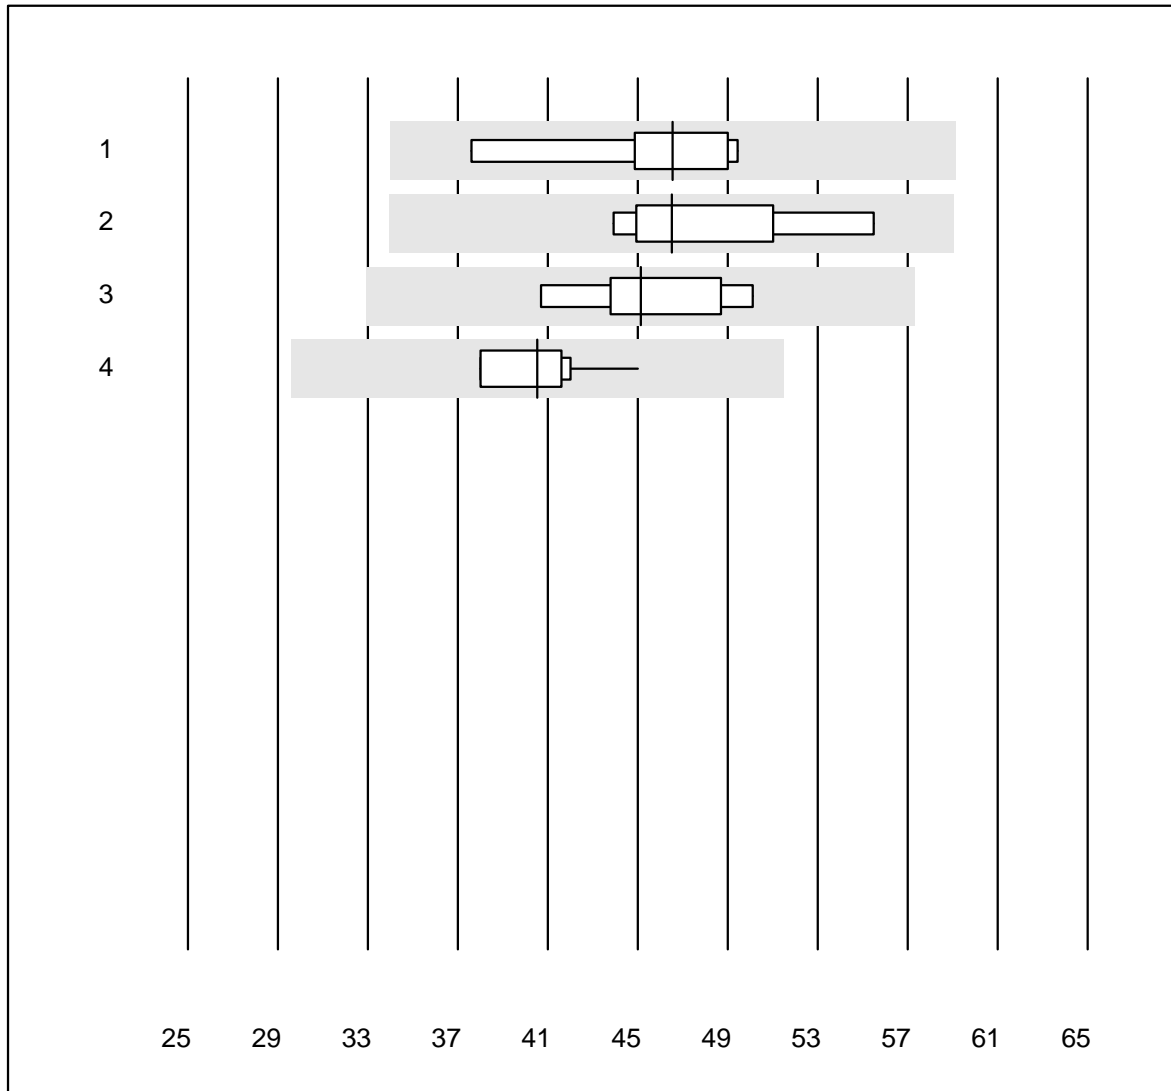


QUALAB Toleranz : 27 %

25-OH Vitamin D (nmol/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	6	100.0	0.0	0.0	46.6	9.4	e*
2 VIDAS	7	100.0	0.0	0.0	46.5	8.4	e
3 Autres méthodes	5	100.0	0.0	0.0	45.1	8.3	e*
4 Architect	12	100.0	0.0	0.0	40.5	5.2	e

AMH

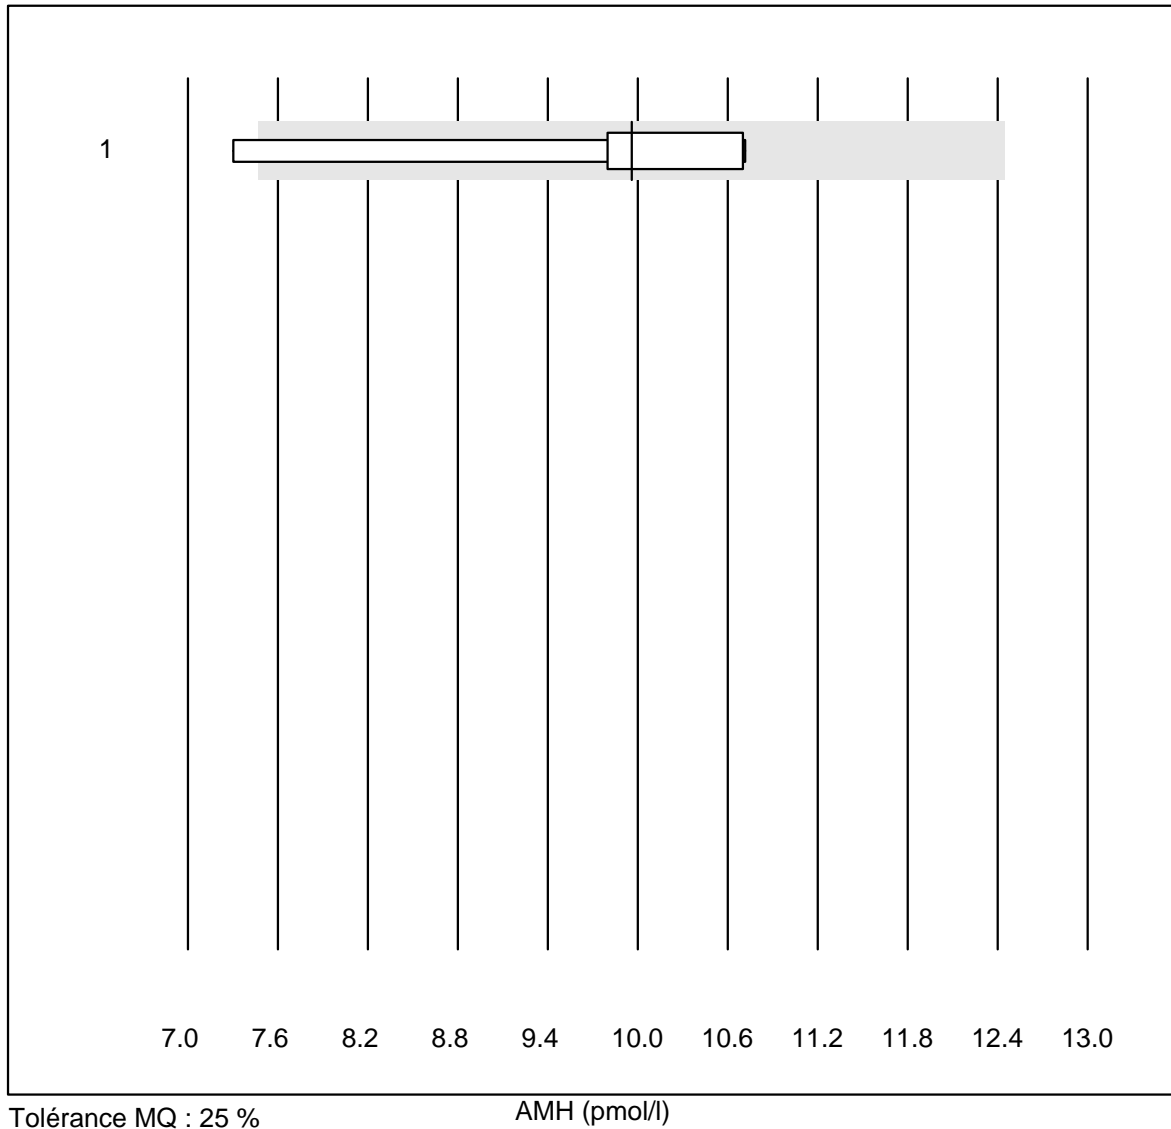


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	6	83.3	16.7	0.0	10.0	12.9	e*

Calcitonin

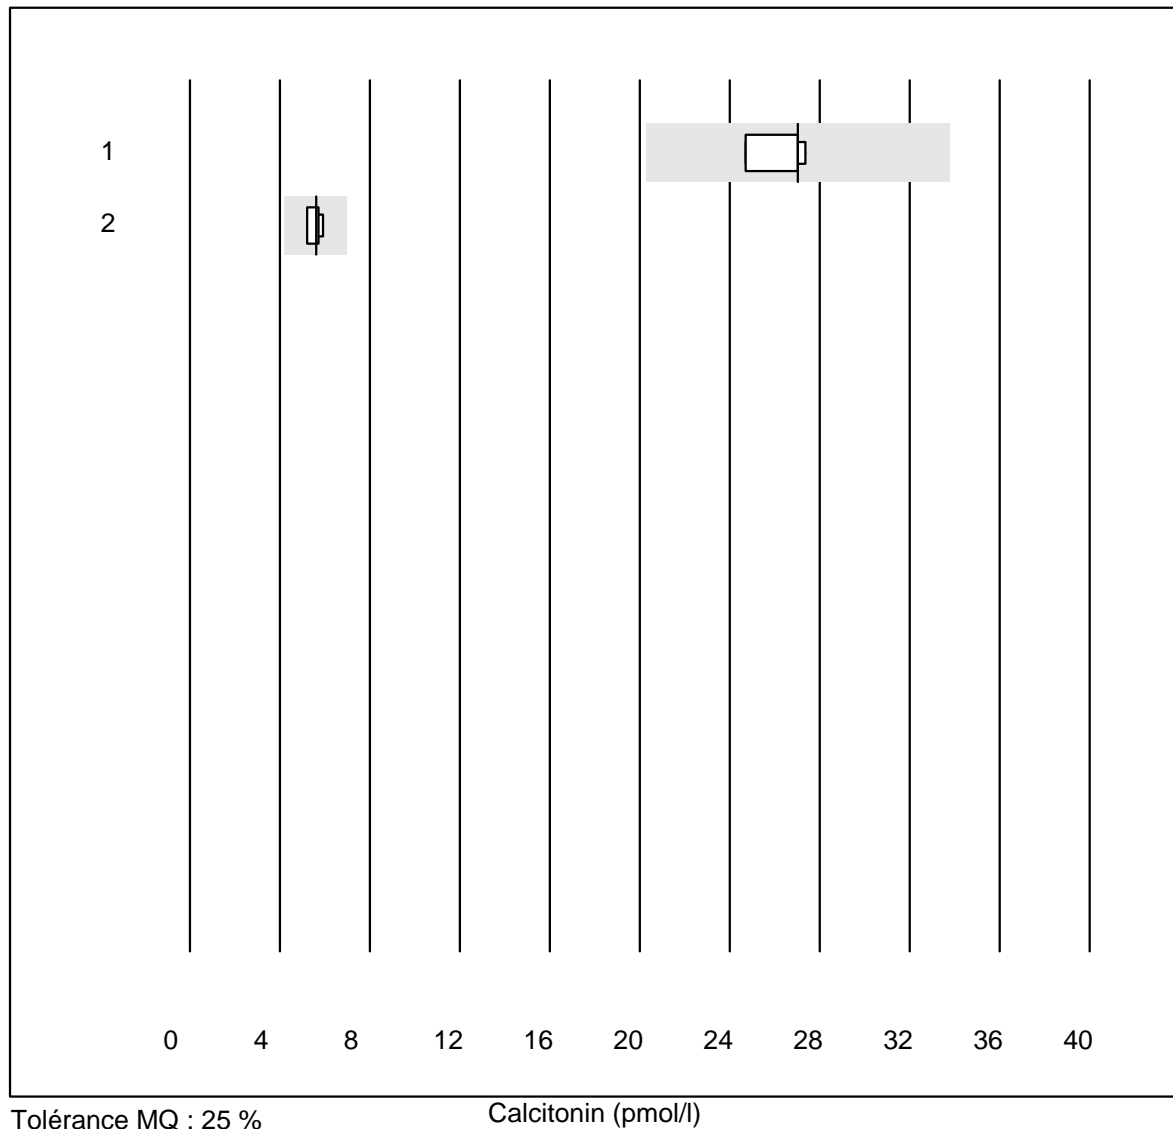

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	27.0	4.6	e
2 Liaison	4	100.0	0.0	0.0	5.6	5.4	e

Anti Thyreoglobulin

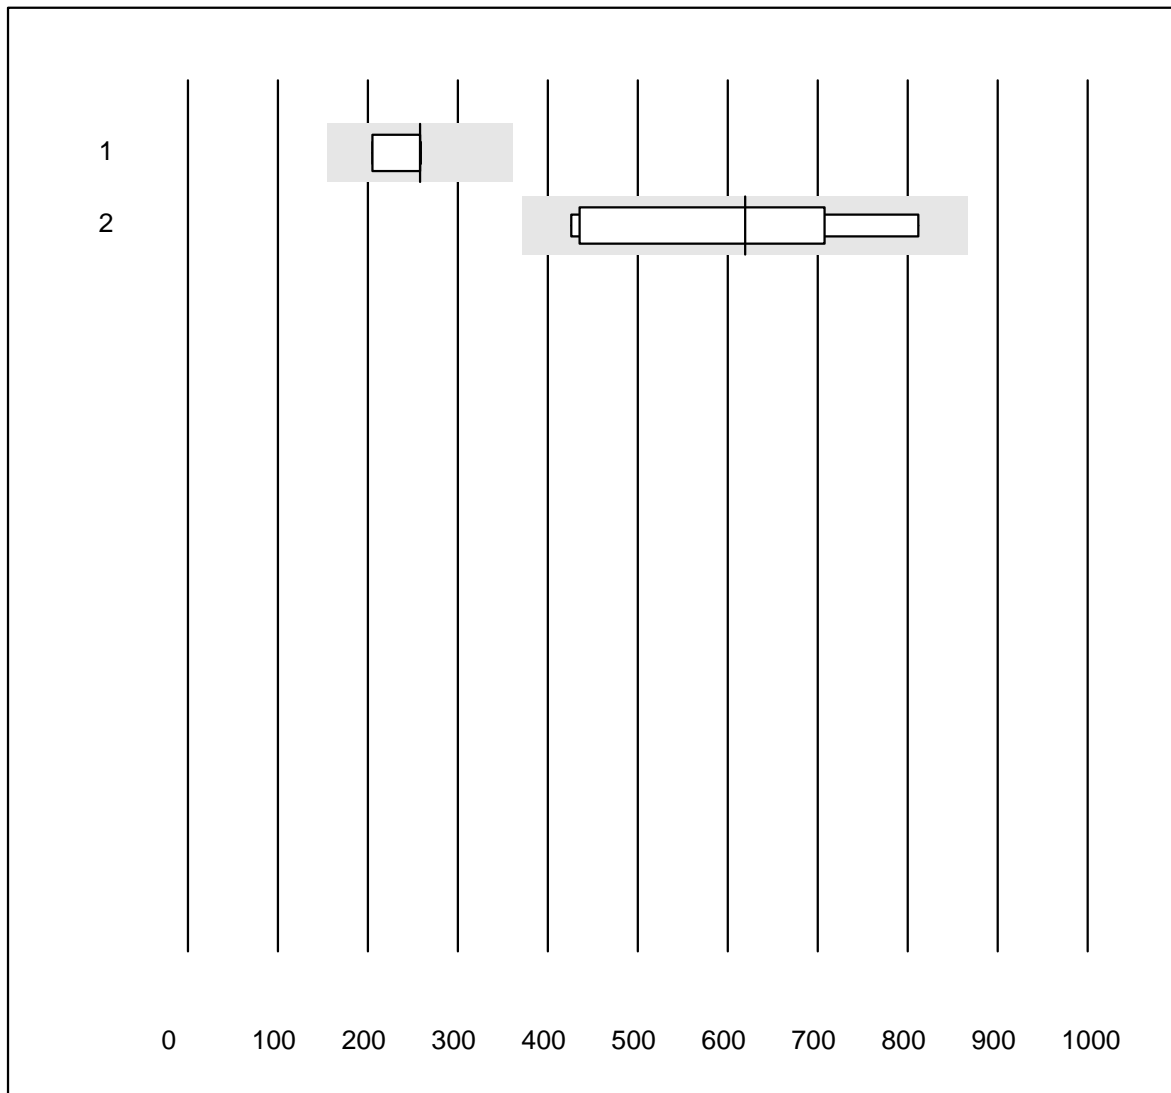


Tolérance MQ : 25 %

Anti Thyreoglobulin (IE/ml)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Liaison	4	100.0	0.0	0.0	258	11.7	a
2 Cobas	6	100.0	0.0	0.0	619	28.0	a

Anti TPO

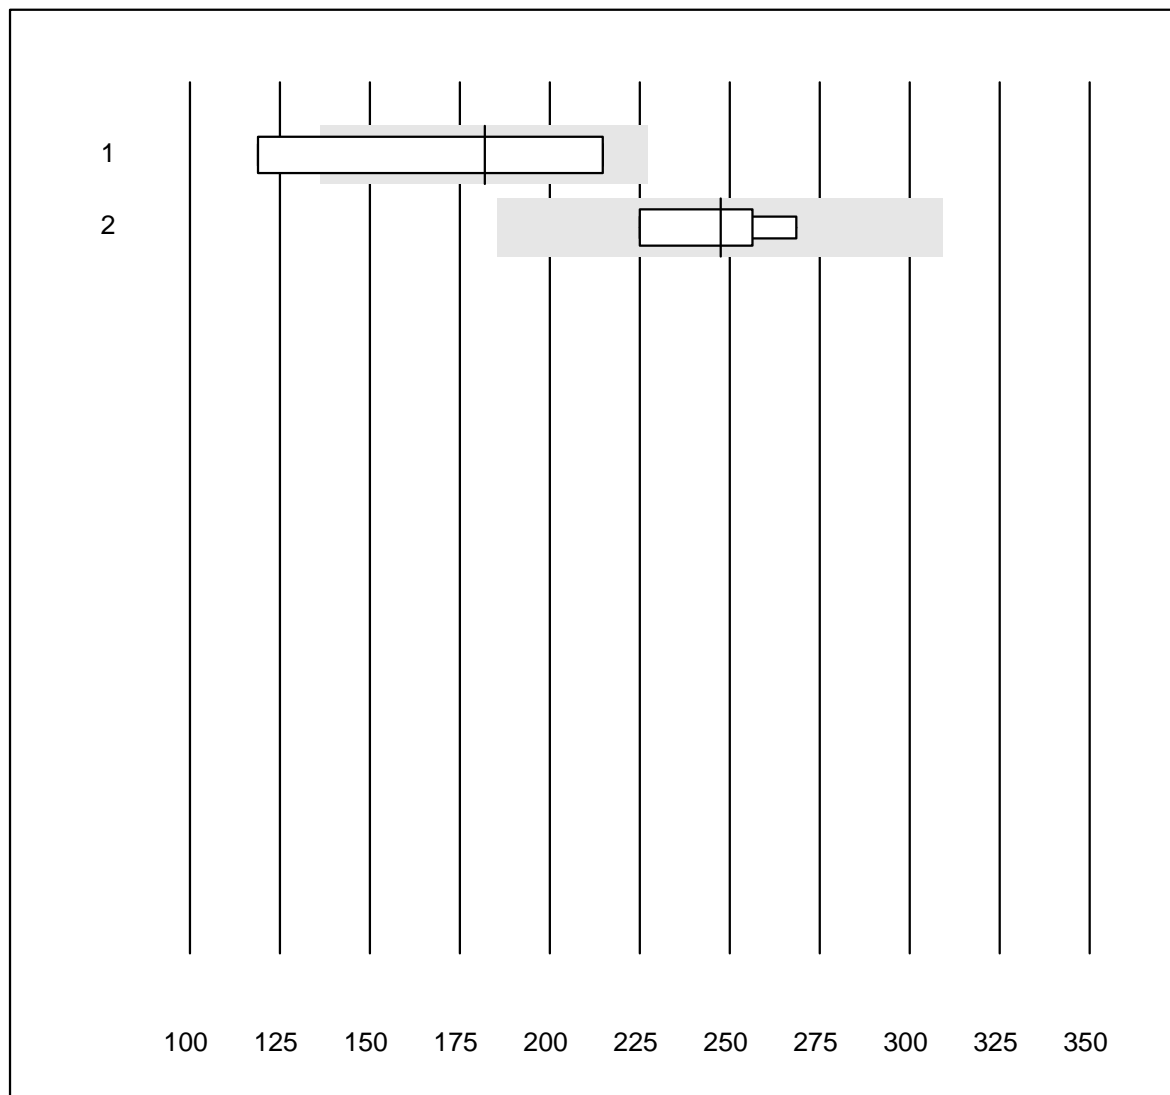


QUALAB Toleranz : 25 %

Anti TPO (IE/ml)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	4	50.0	25.0	25.0	182	30.4	e*
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	247	7.8	e*

TRAK

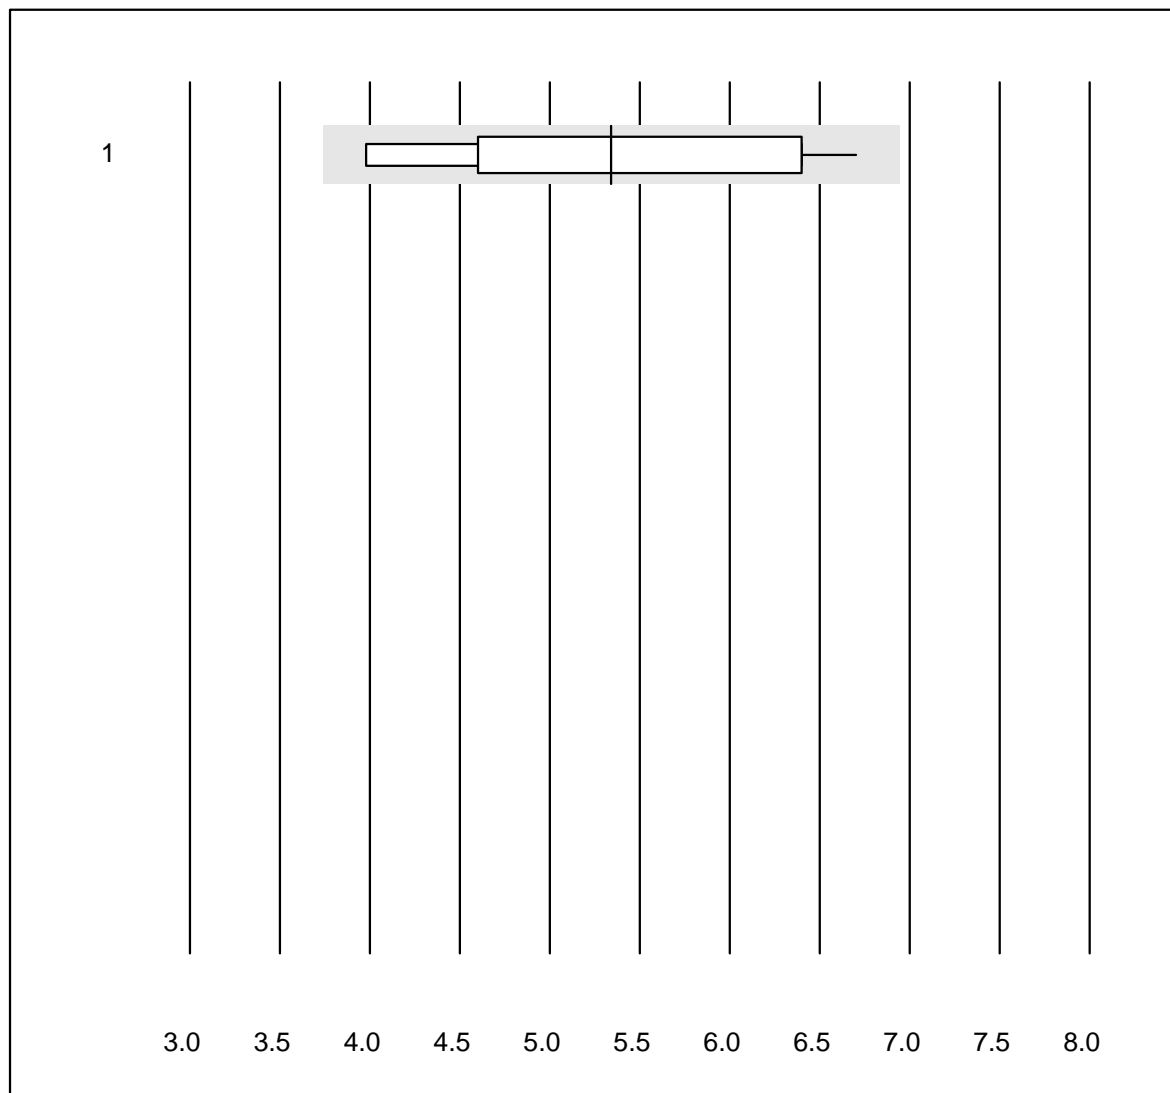


Tolérance MQ : 25 %

TRAK (IE/ml)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	10	100.0	0.0	0.0	5.34	18.1	a

Créatinine WB

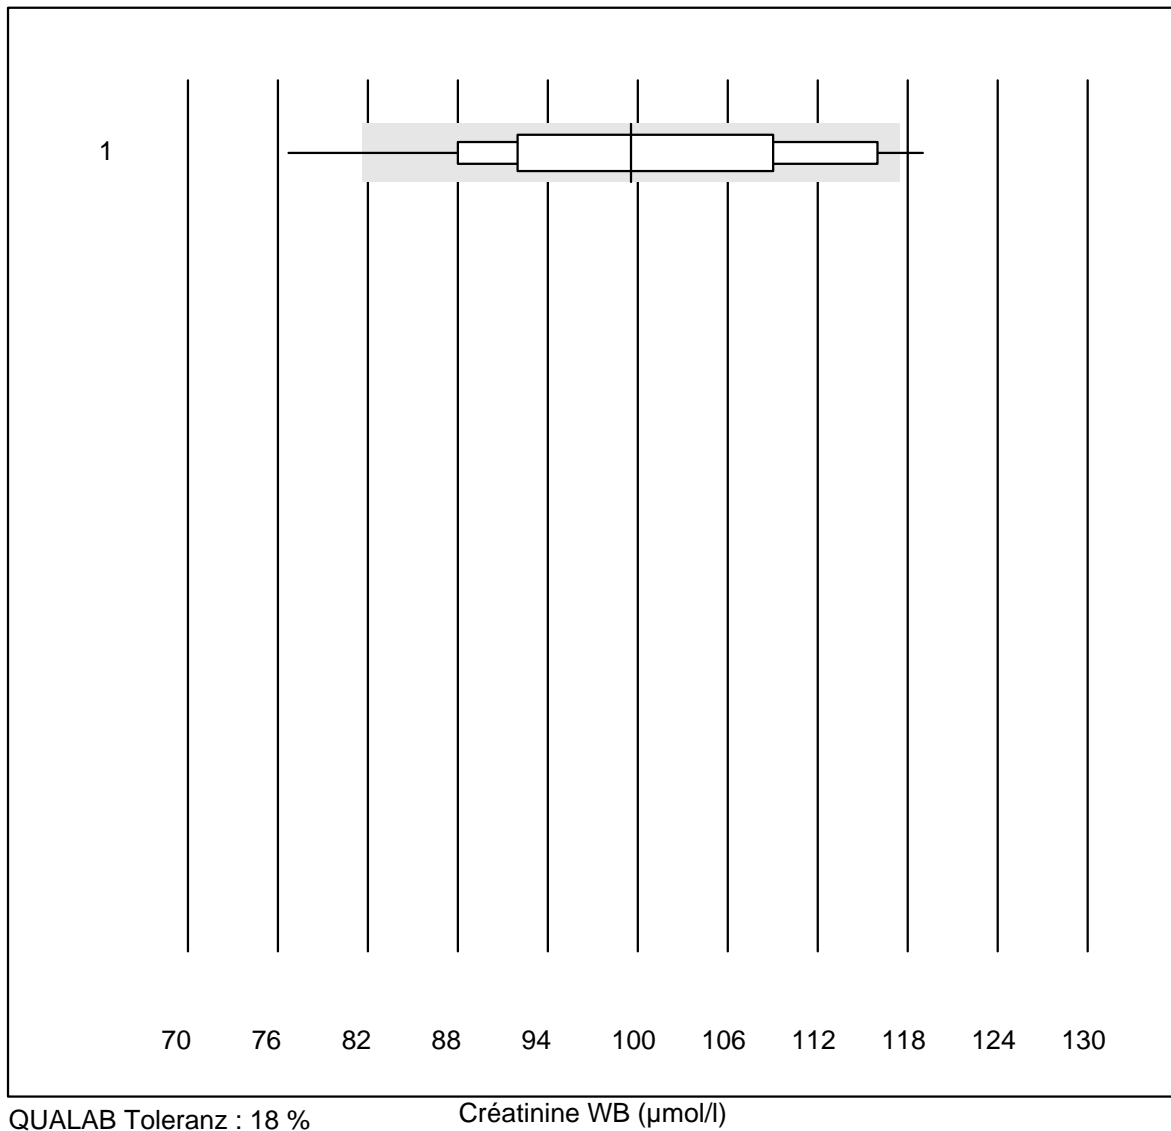

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Statsensor i / Nova	32	84.4	12.5	3.1	100	11.3	e

Amylase-urine

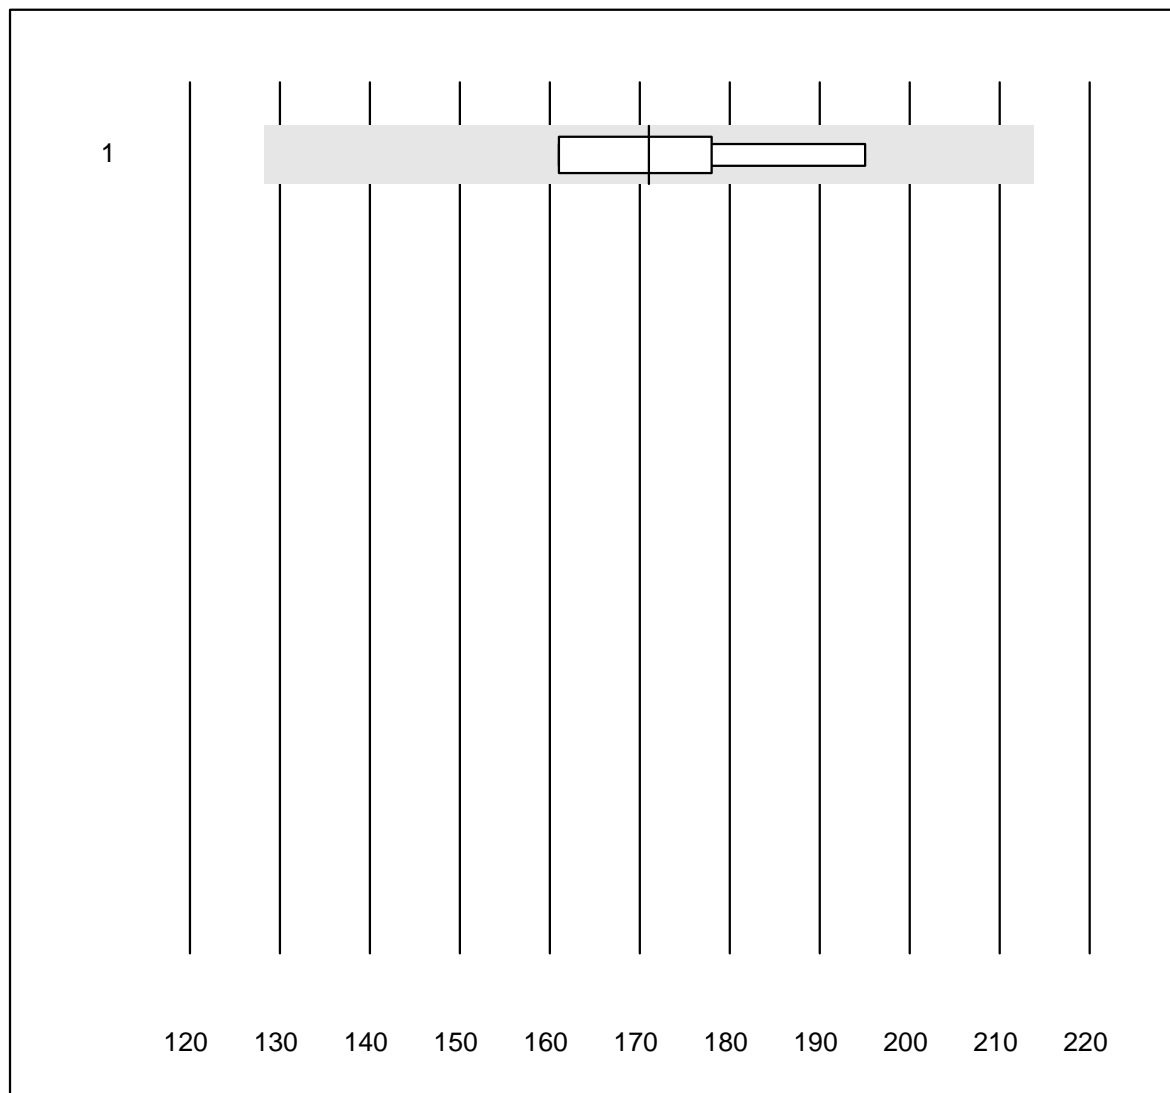


Tolérance MQ : 25 %

Amylase-urine (U/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	4	100.0	0.0	0.0	171	8.9	e*

Panc. Amylase-urine

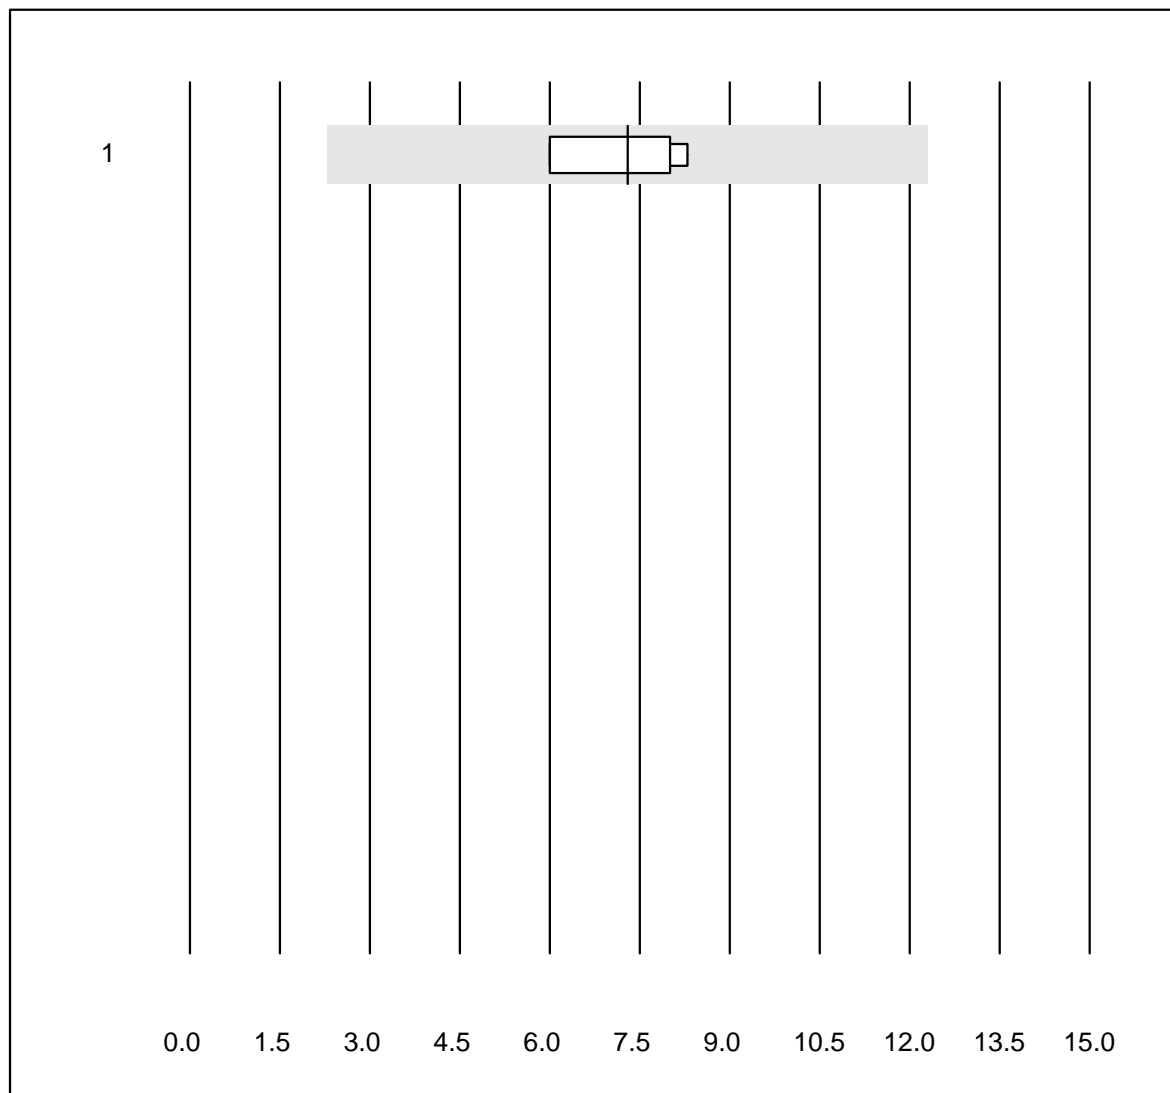


QUALAB Toleranz : 18 %
(< 25.0: +/- 5.0 U/l)

Panc. Amylase-urine (U/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	4	100.0	0.0	0.0	7.3	15.3	e*

Calcium-urine

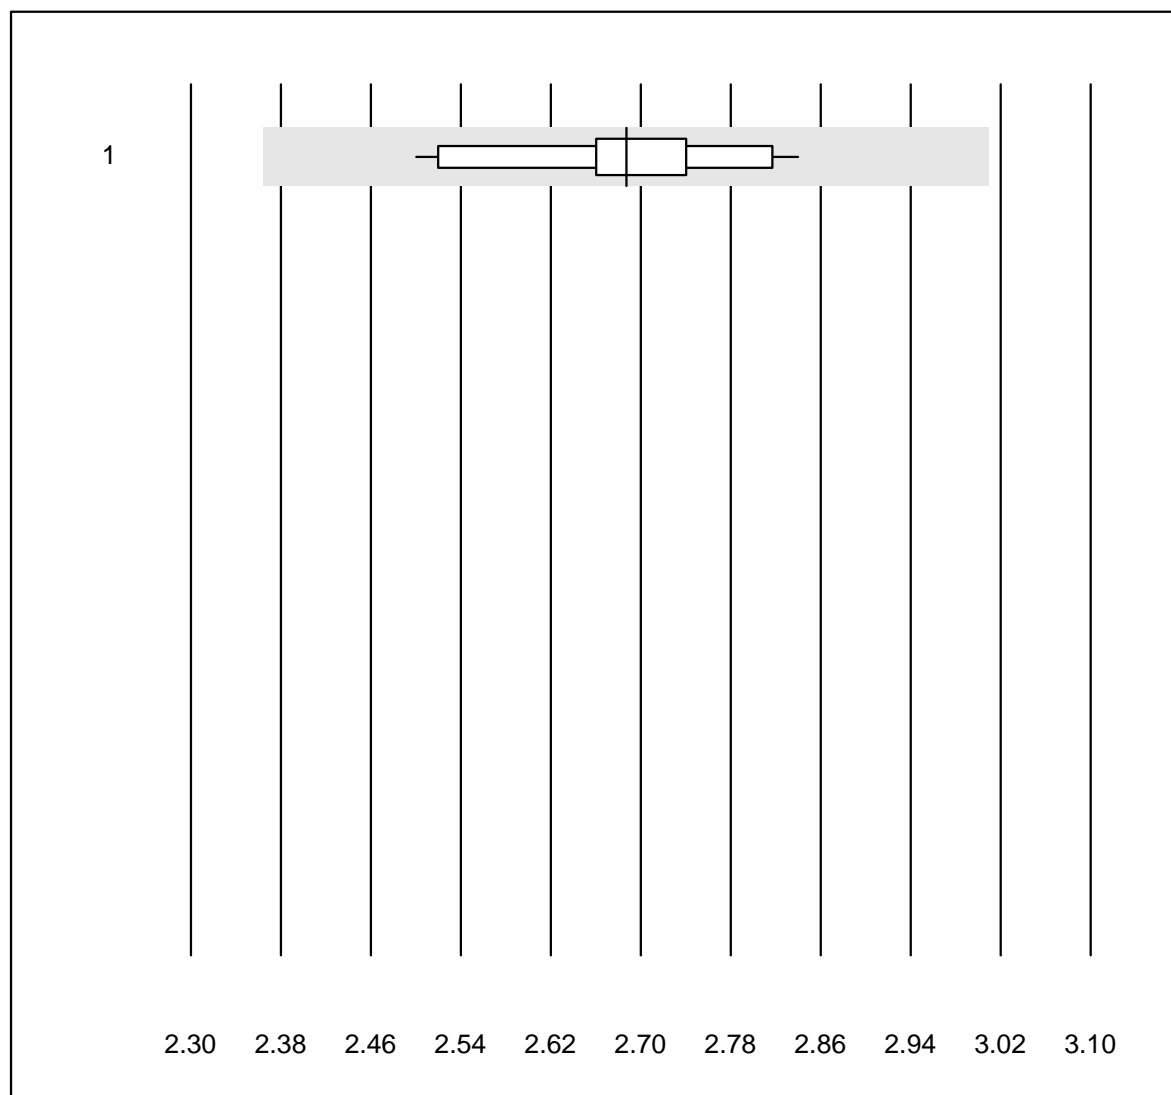


Tolérance MQ : 12 %

Calcium-urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	17	100.0	0.0	0.0	2.69	3.5	e

Chlorures-urine

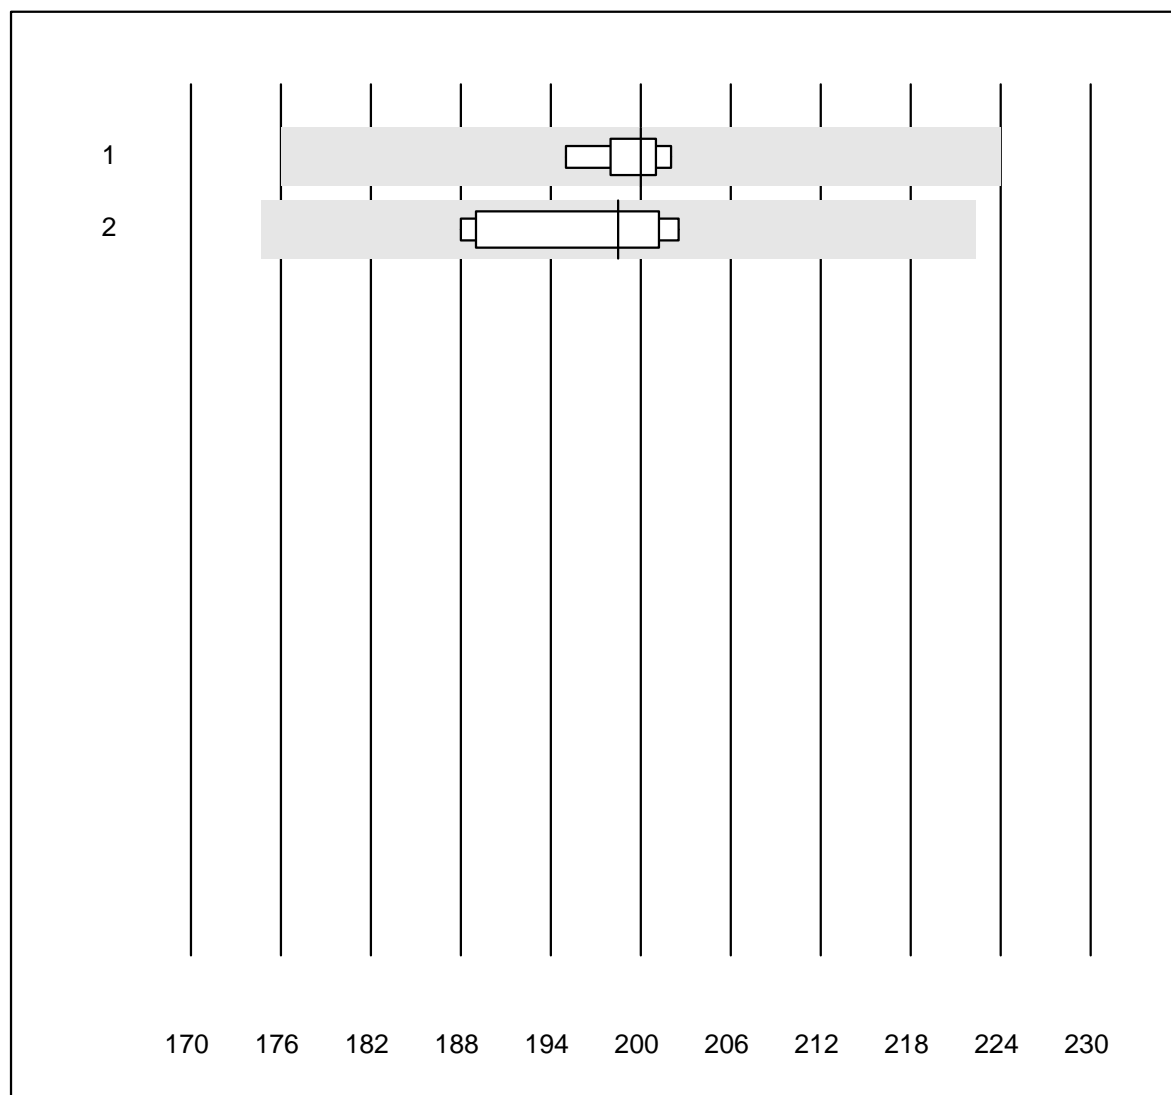


Tolérance MQ : 12 %

Chlorures-urine (mmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	7	100.0	0.0	0.0	200	1.1	e
2	Cobas	6	100.0	0.0	0.0	199	3.2	e

Glucose-urine

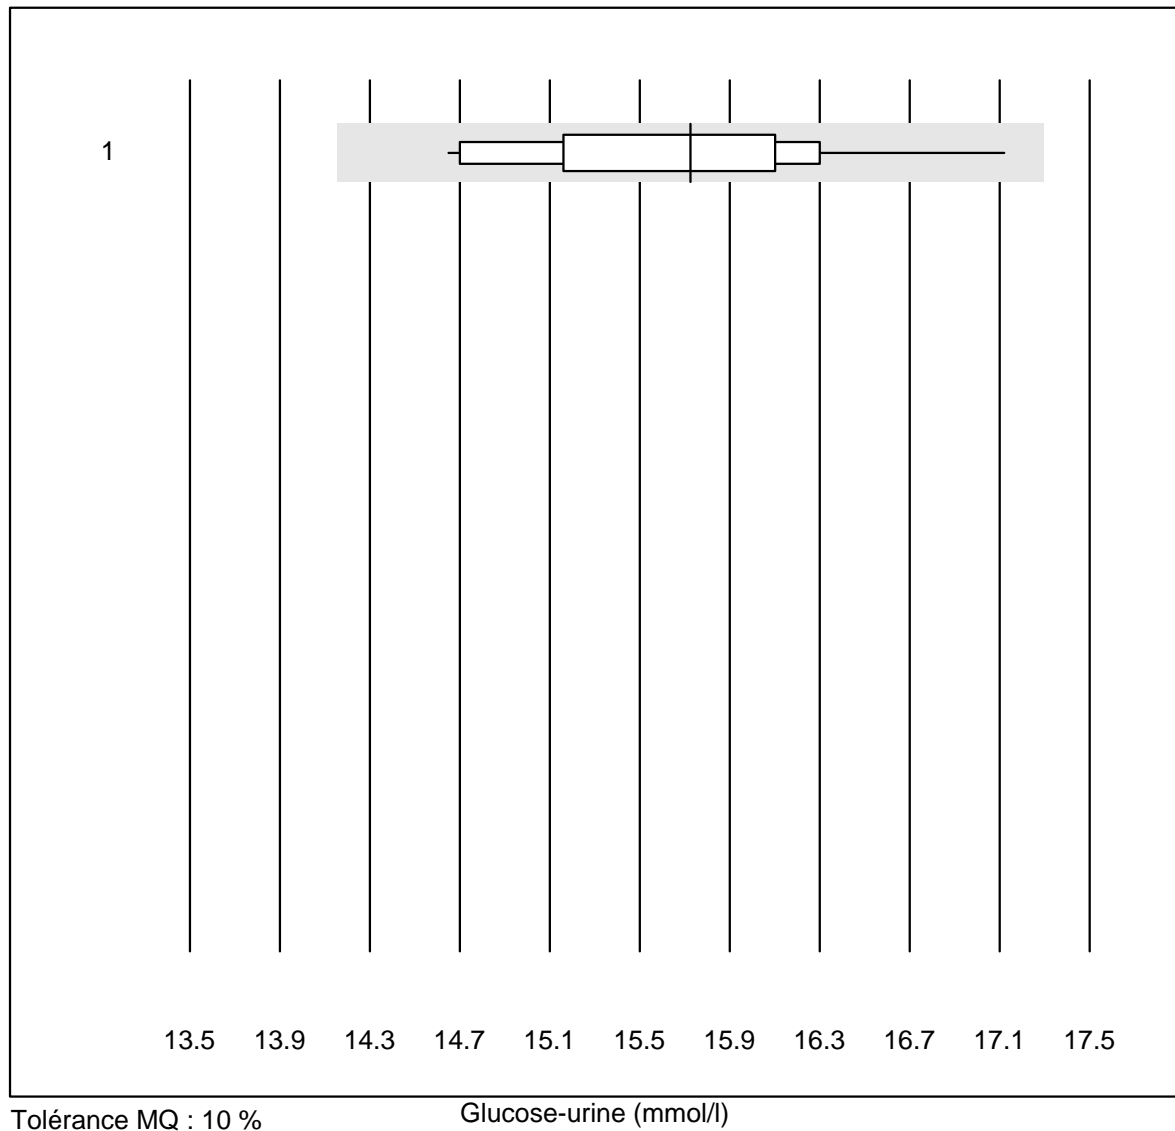

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	19	100.0	0.0	0.0	15.7	3.9	e

Magnésium-urine

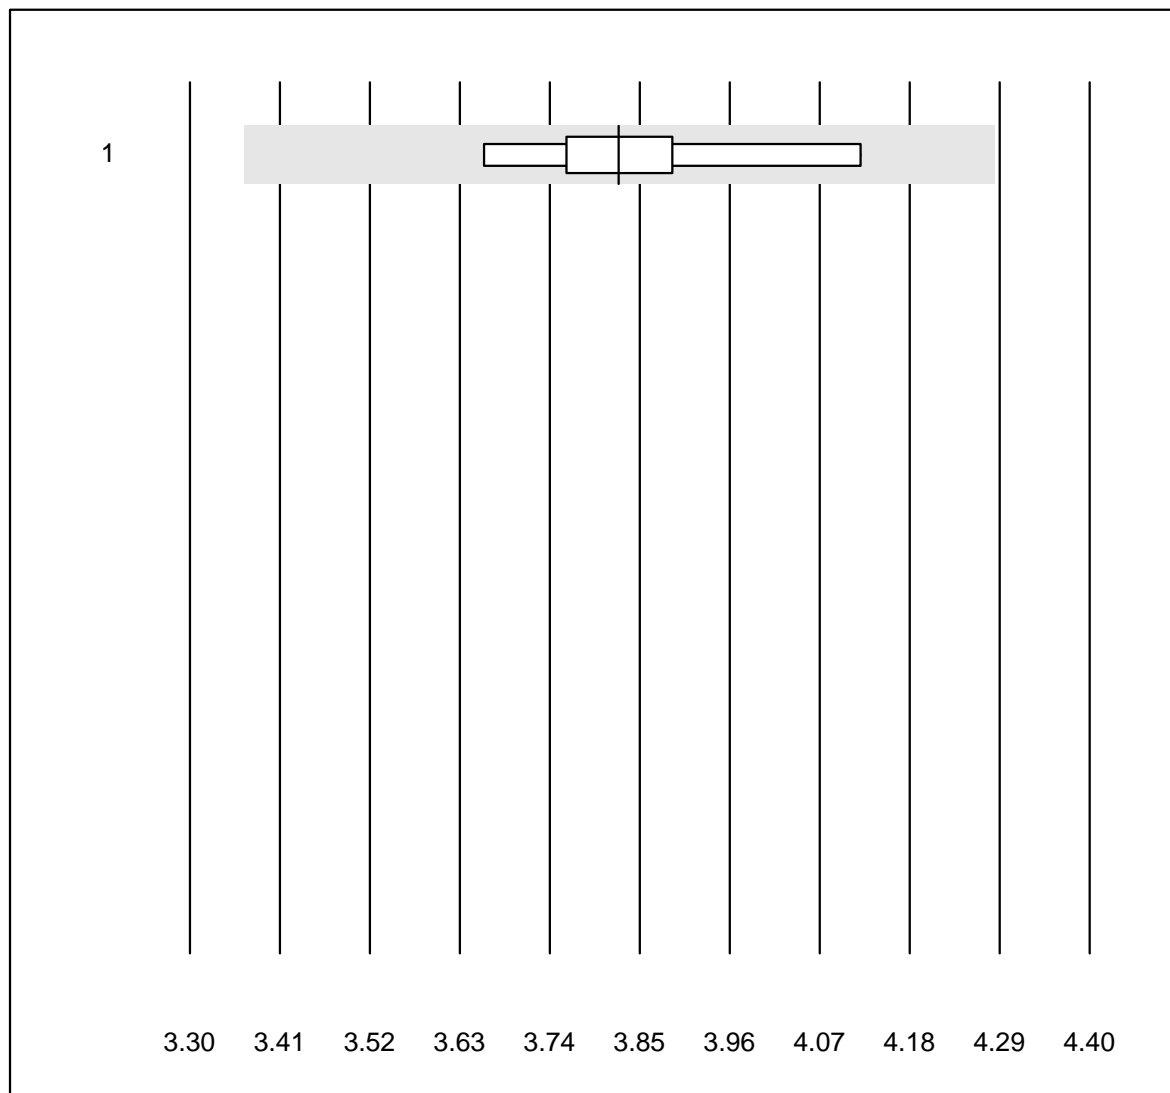


Tolérance MQ : 12 %

Magnésium-urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	8	100.0	0.0	0.0	3.82	3.7	e

Osmolalité-urine

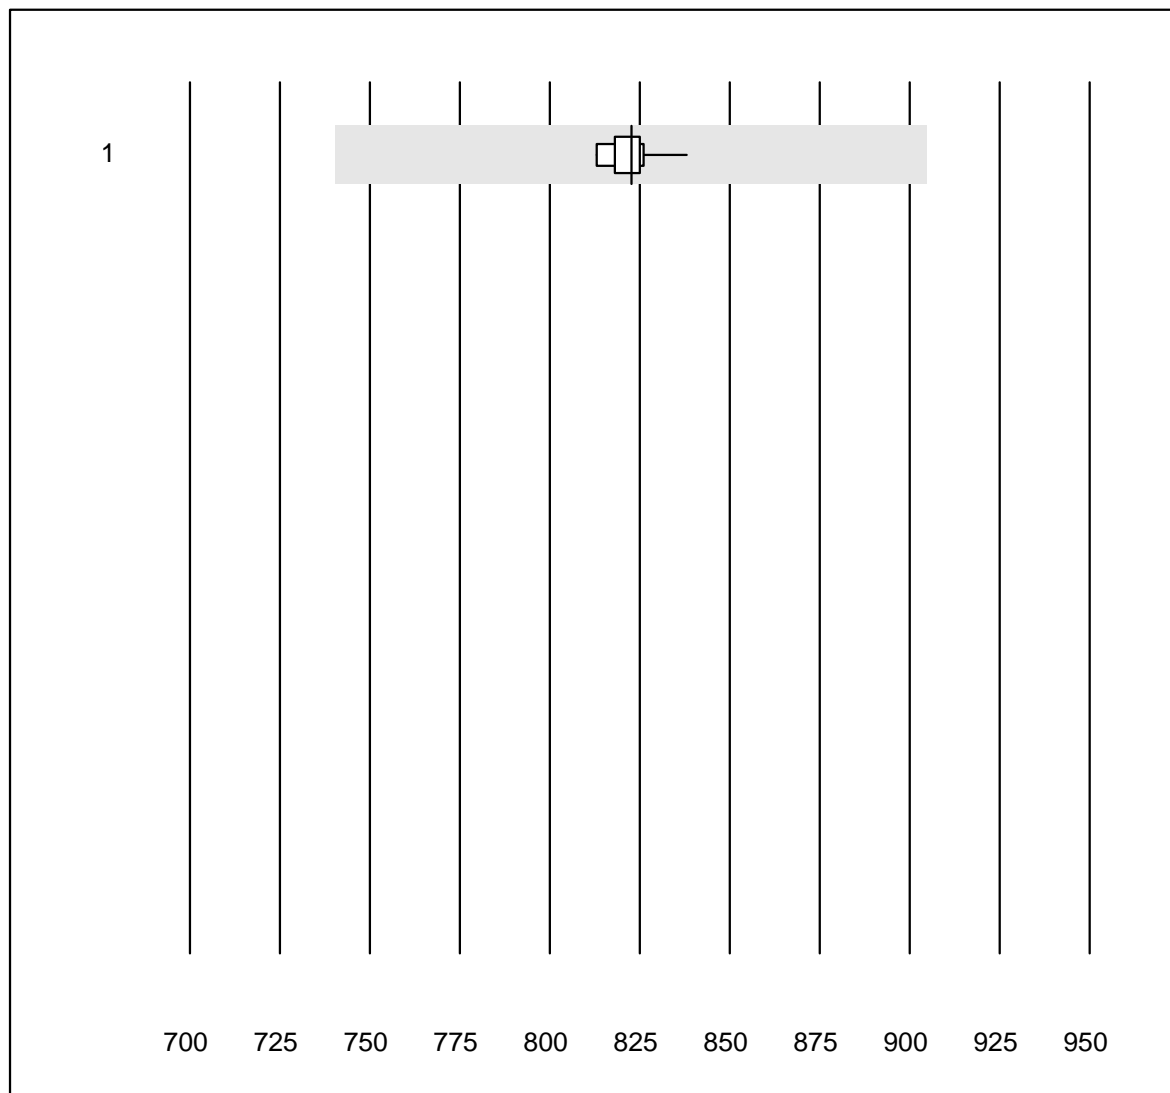


Tolérance MQ : 10 %

Osmolalité-urine (mosm/kg)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cryoscopie	10	100.0	0.0	0.0	823	0.8	e

Phosphore-urine

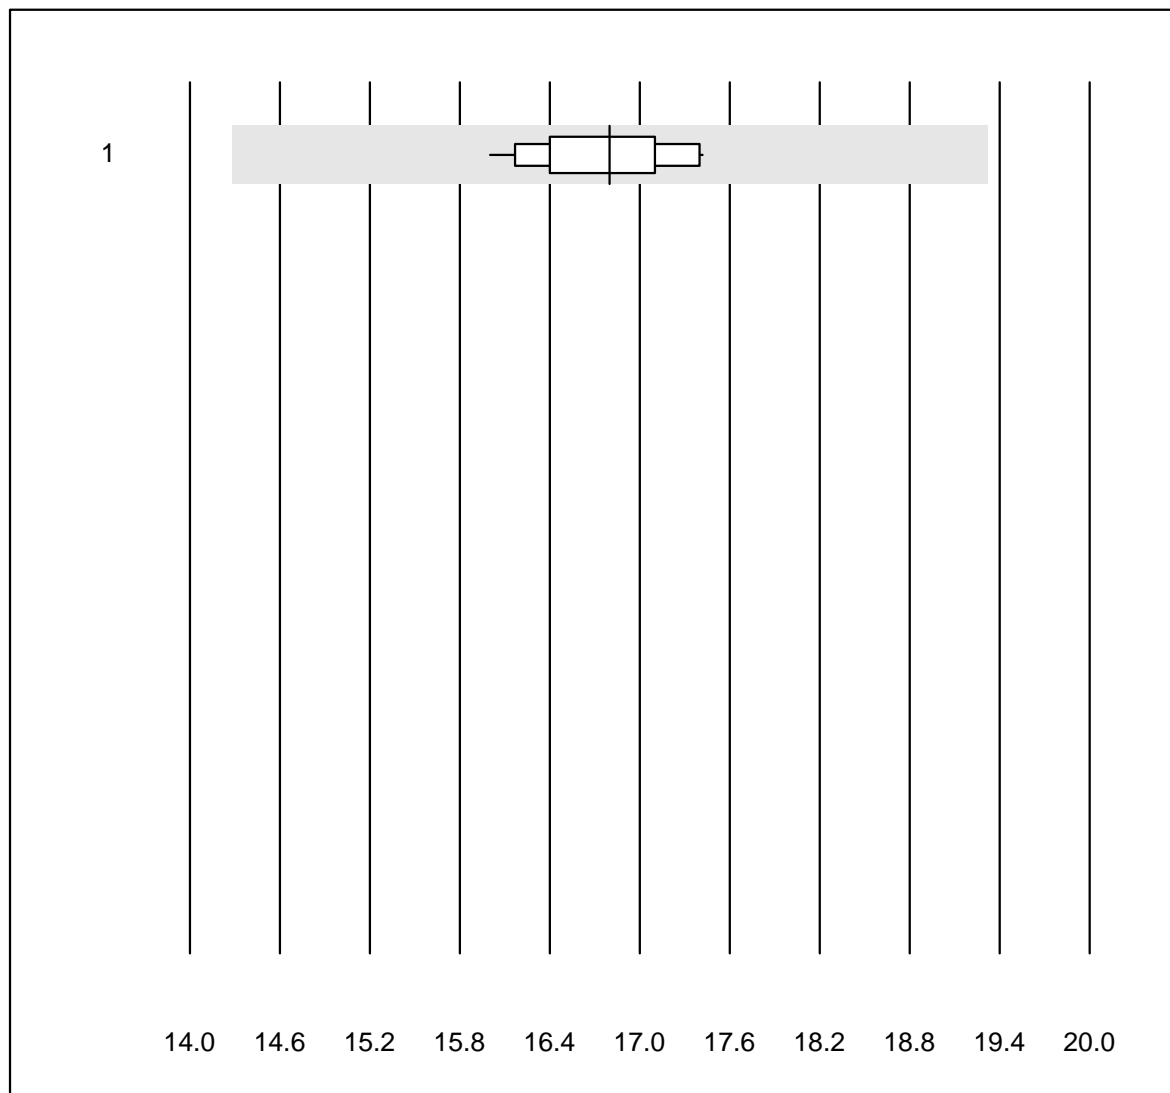


Tolérance MQ : 15 %

Phosphore-urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Efulft	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	15	100.0	0.0	0.0	16.8	2.6	e

Potassium-urine

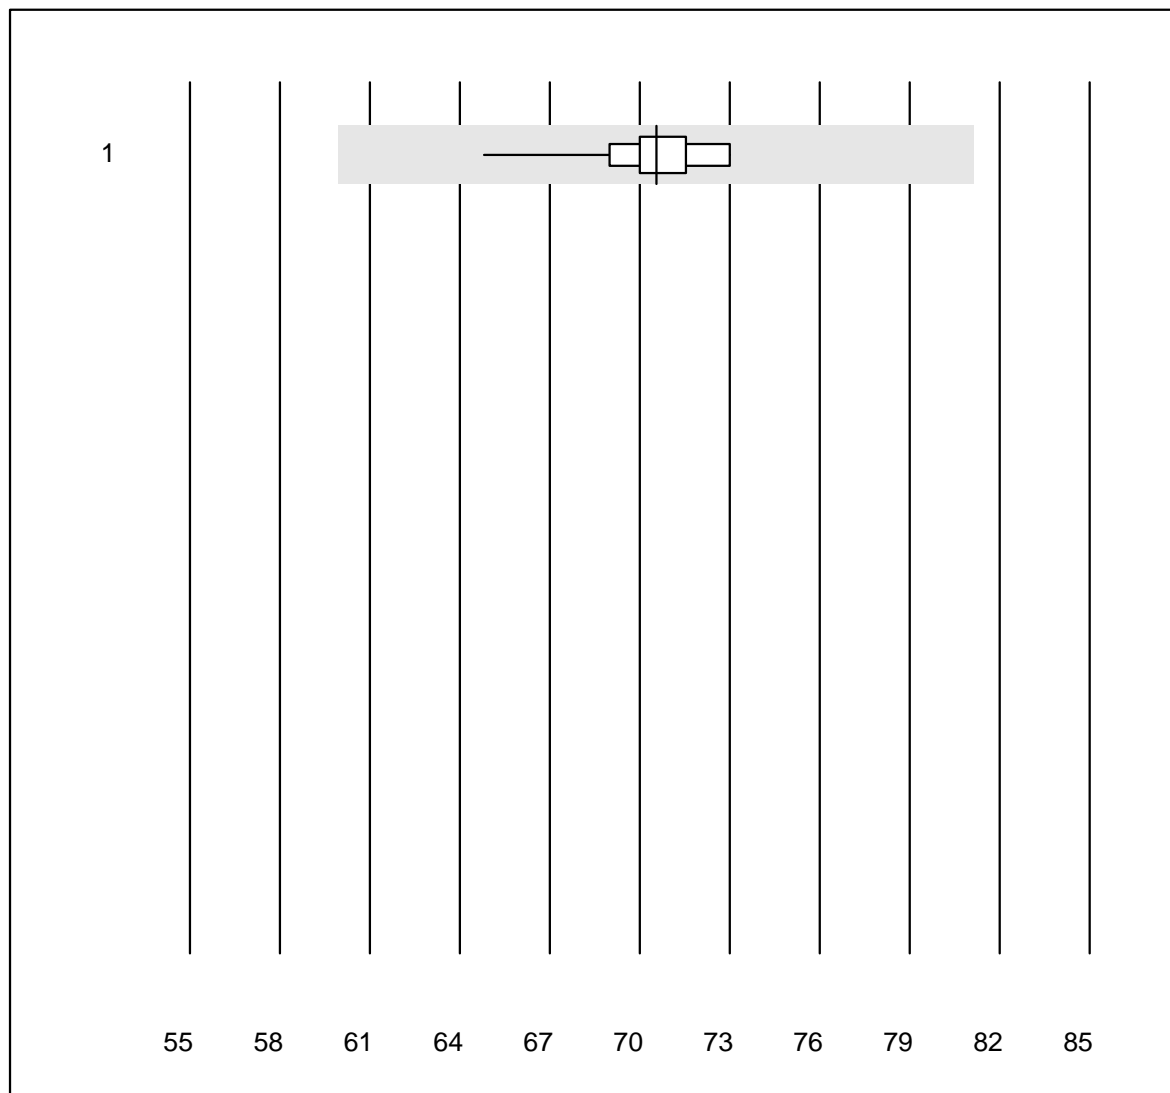


Tolérance MQ : 15 %

Potassium-urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	23	100.0	0.0	0.0	71	2.9	e

Protéines-urine

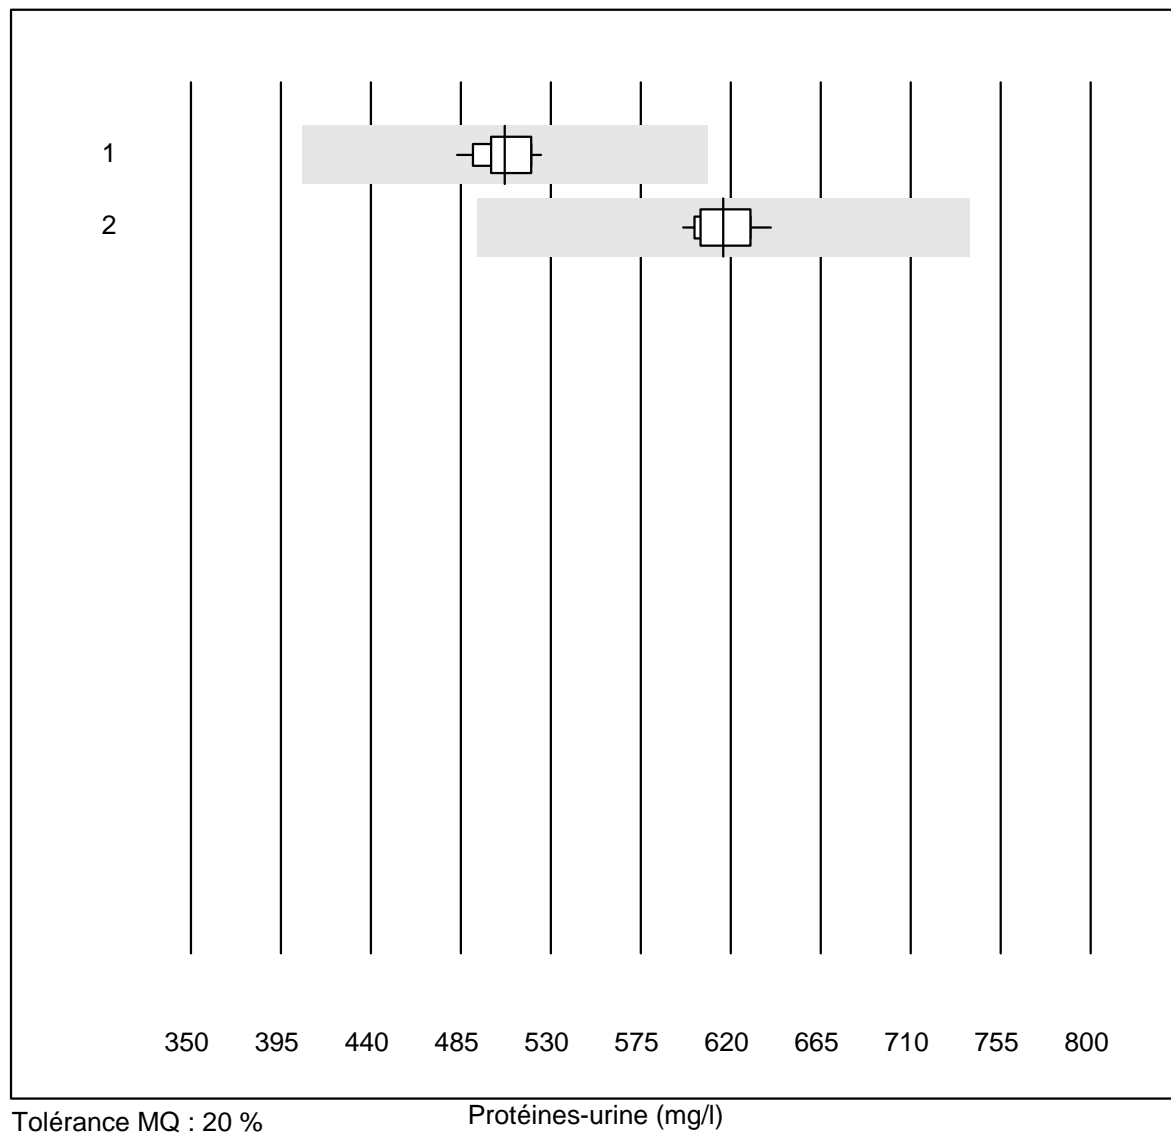


Tolérance MQ : 20 %

Protéines-urine (mg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas/Roche	12	91.7	0.0	8.3	507.0	2.5	e
2	Chimie humide	11	100.0	0.0	0.0	616.3	2.2	e

Sodium-urine

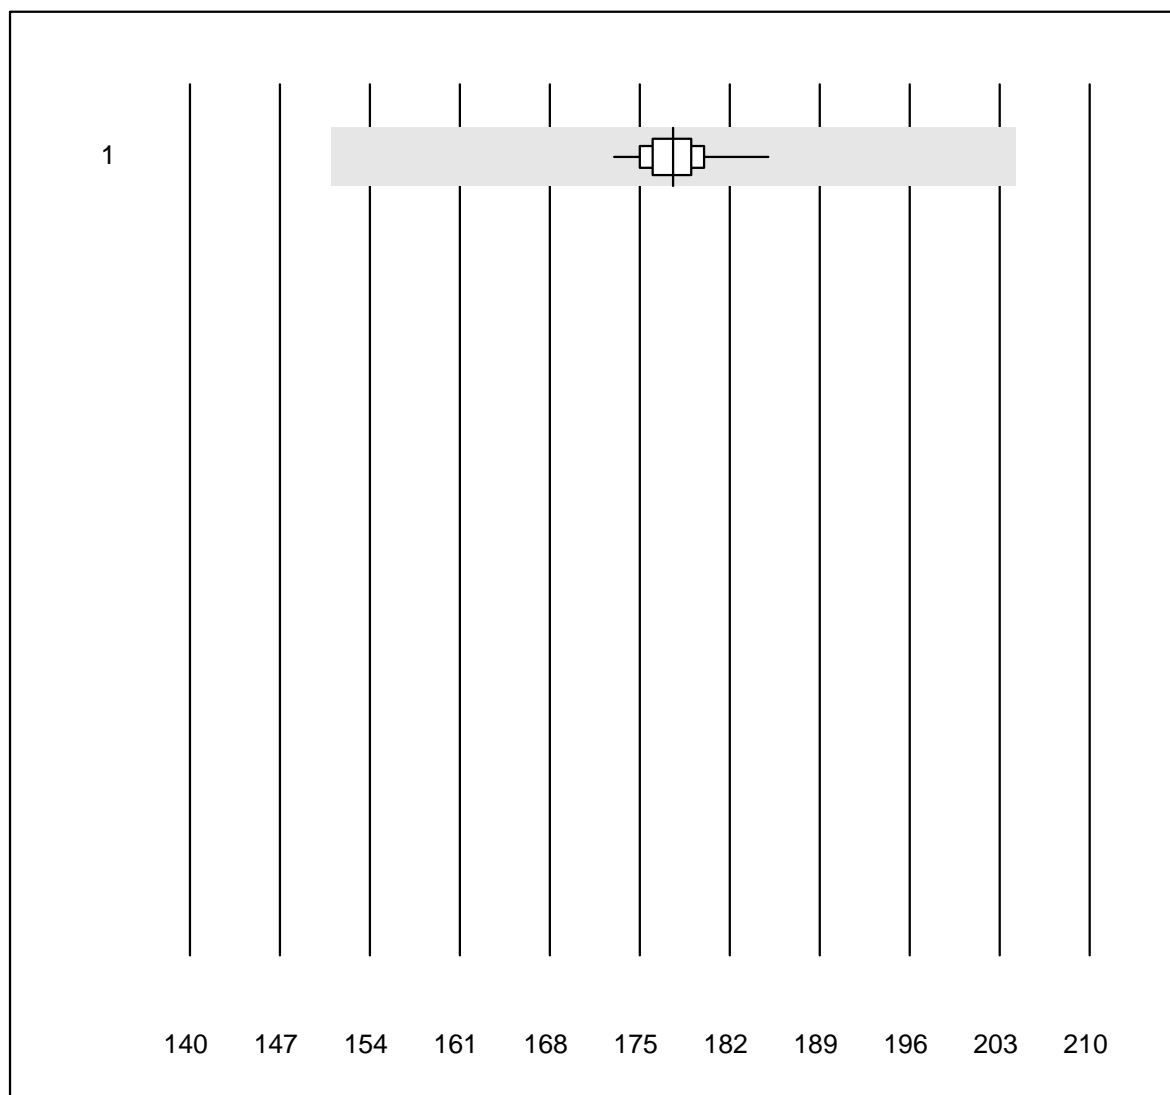


Tolérance MQ : 15 %

Sodium-urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	23	100.0	0.0	0.0	178	1.4	e

Urée-urine

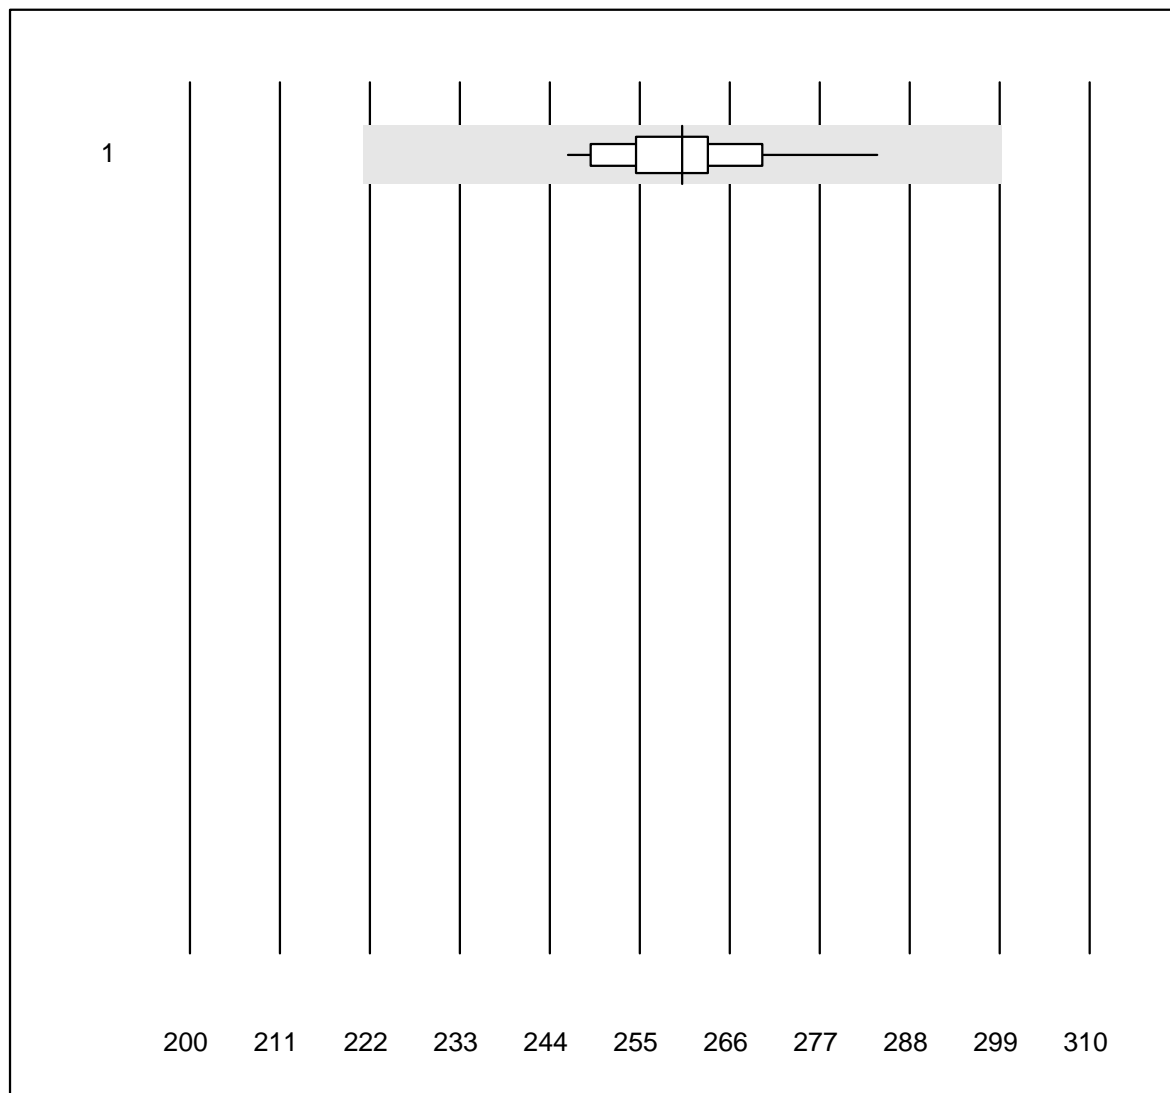


Tolérance MQ : 15 %

Urée-urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	18	100.0	0.0	0.0	260	3.4	e

Acide urique-urine

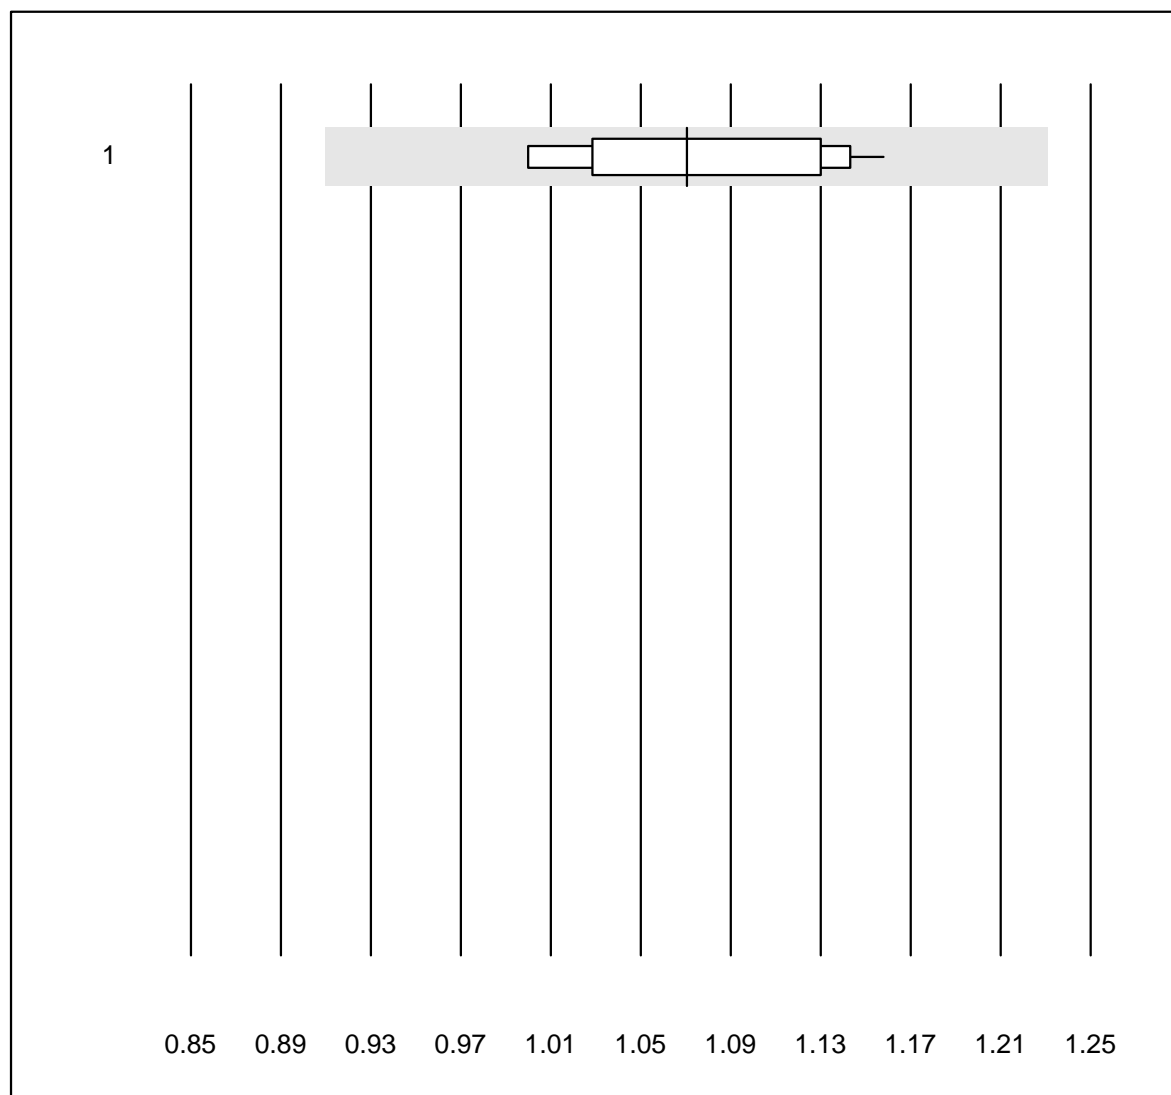


Tolérance MQ : 15 %

Acide urique-urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	14	100.0	0.0	0.0	1.07	5.1	e

Gravité spécifique-urine

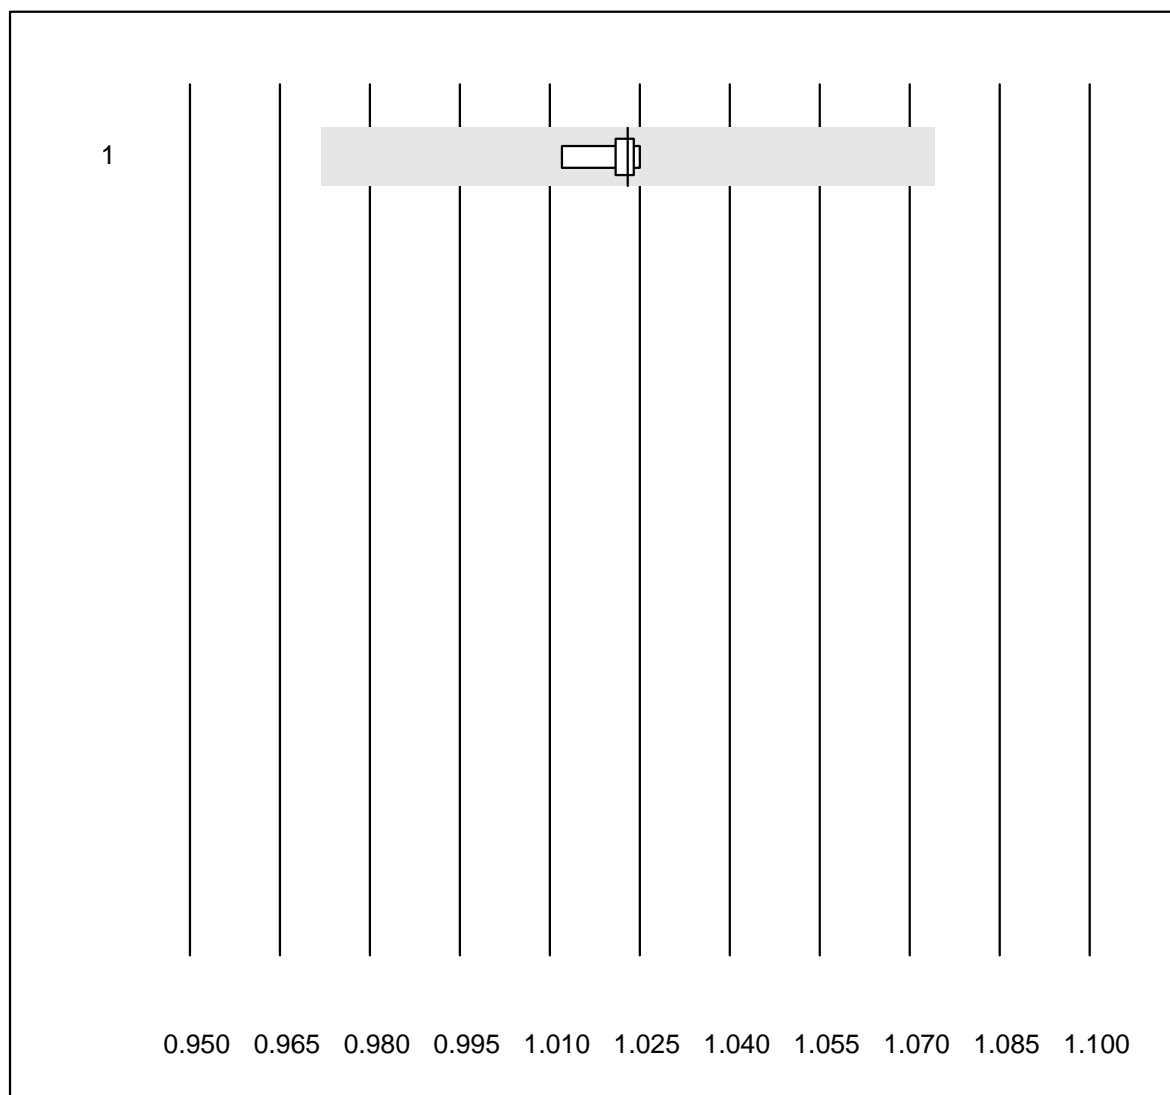


Tolérance MQ : 5 %

Gravité spécifique-urine ()


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Refraktometer	7	100.0	0.0	0.0	1.023	0.4	e

Microalbumine

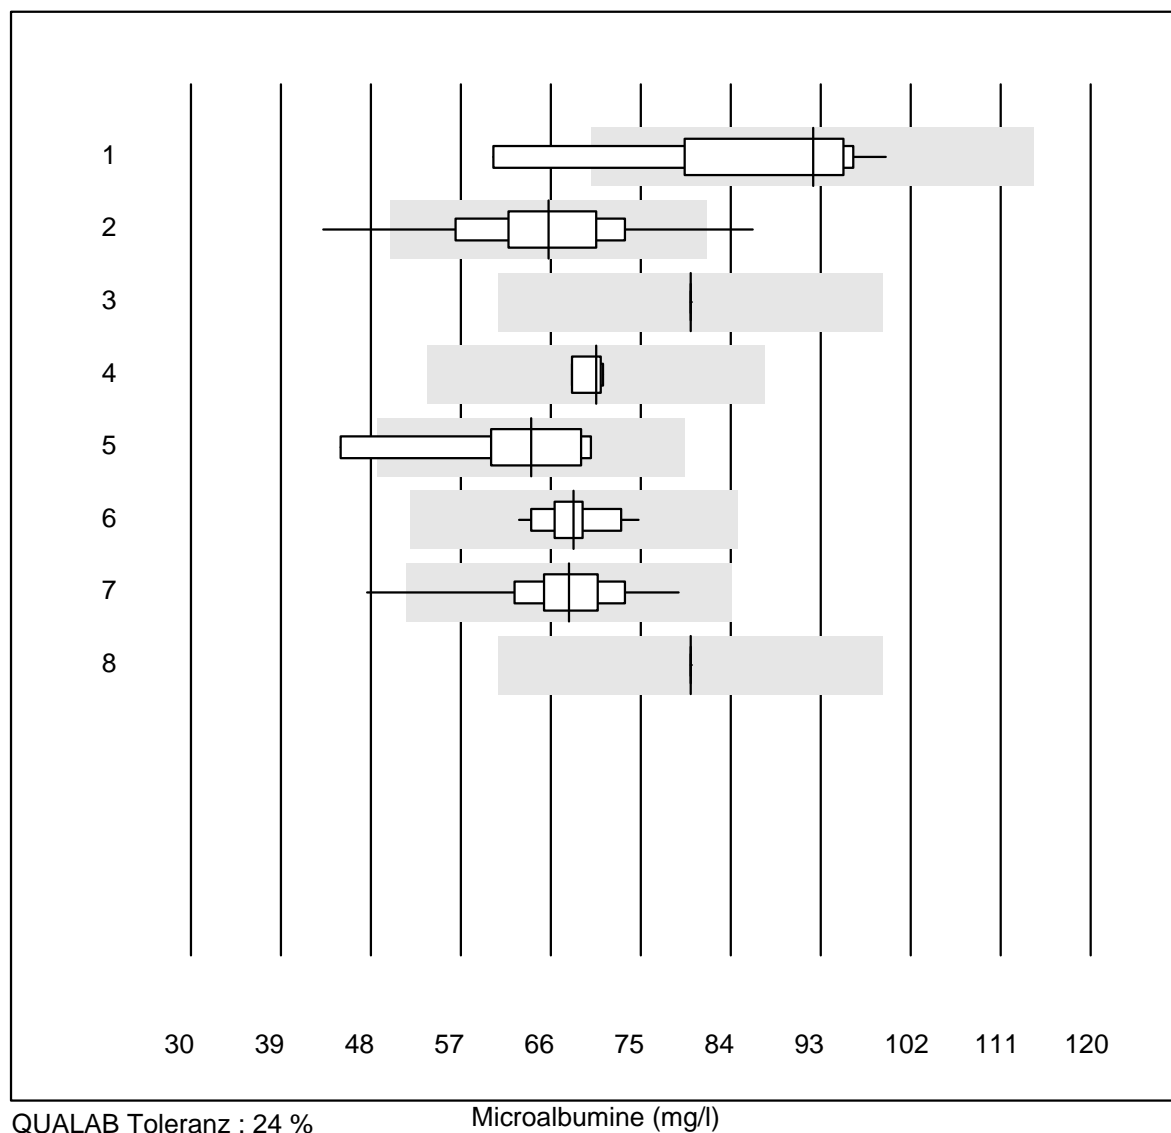

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	AFIAS	10	80.0	20.0	0.0	92.2	16.8	e*
2	Afinion	411	95.6	2.2	2.2	65.8	10.3	e
3	Systemex U	14	71.4	0.0	28.6	80.0	0.0	a
4	Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	70.5	2.0	e
5	NycoCard	6	83.3	16.7	0.0	64.0	14.8	e*
6	Turbidimetrie	22	100.0	0.0	0.0	68.3	4.5	e
7	DCA2000/Vantage	137	97.1	0.7	2.2	67.8	6.7	e
8	Siemens Clinitek	10	70.0	0.0	30.0	80.0	0.0	a

Créatinine urine

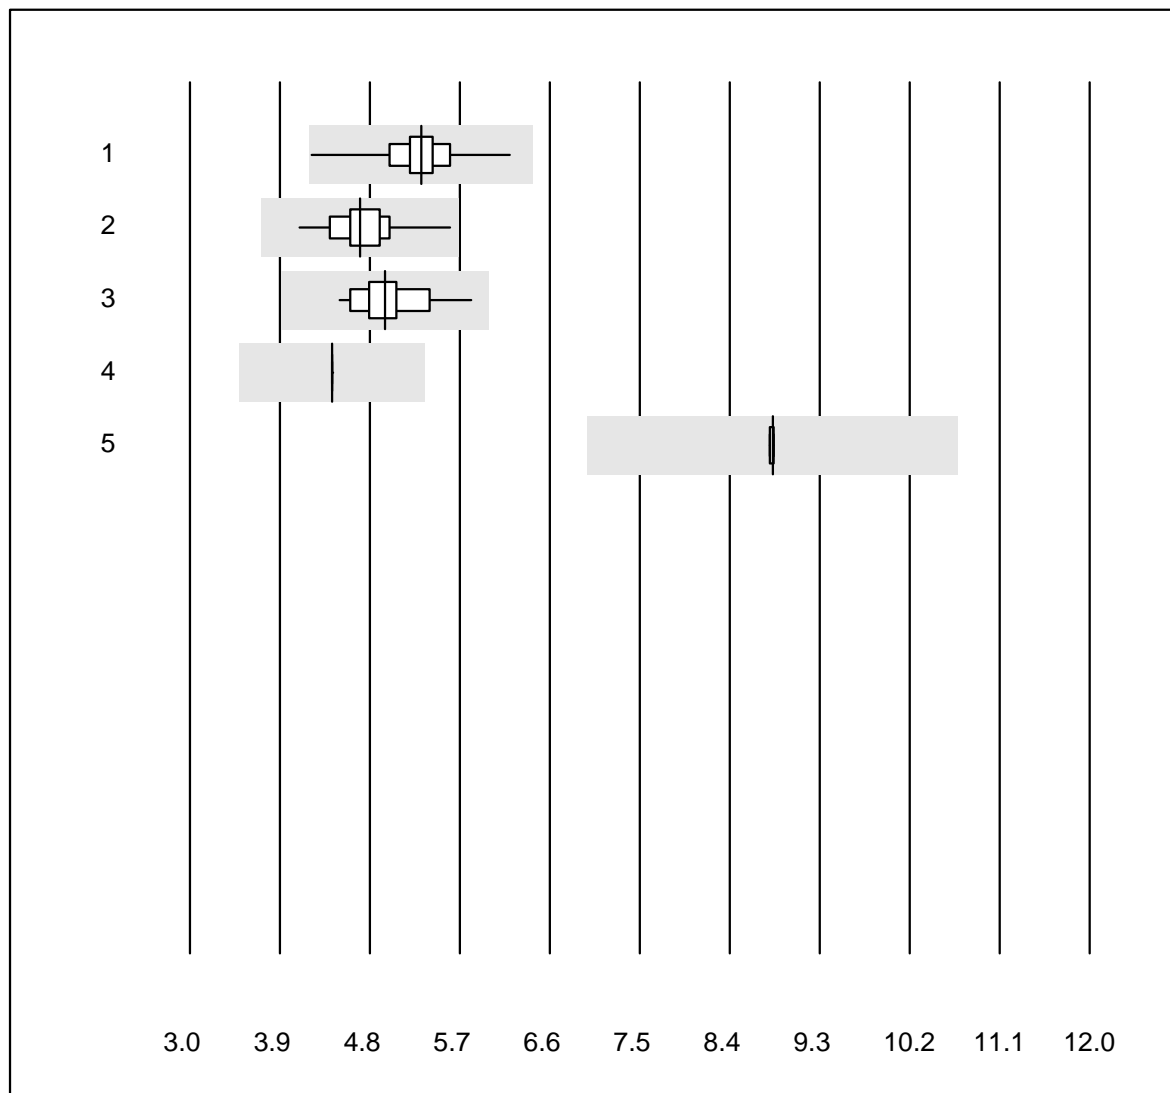

QUALAB Toleranz : 21 %

Créatinine urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	DCA2000/Vantage	137	96.4	0.0	3.6	5.3	5.2	e
2	Afinion	411	98.5	0.0	1.5	4.7	5.1	e
3	Chimie humide	38	100.0	0.0	0.0	5.0	5.7	e
4	Sysmex U	14	50.0	0.0	50.0	4.4	0.0	a
5	Siemens Clinitek	10	70.0	0.0	30.0	8.8	0.2	a