

Verein für
Association pour le
Associazione per il



medizinische Qualitätskontrolle
contrôle de qualité médical
controllo di qualità medico

Commentaire de l'essai interlaboratoire

2019 - 3

Échantillons de l'essai interlaboratoire

L'homogénéité et la stabilité ont été vérifiées pour tous les échantillons avant respectivement pendant l'envoi et aucune anomalie n'a été constatée. Les tests de conformité ont été réalisés par les laboratoires de l'Hôpital Universitaire de Zürich (<http://www.uzl.usz.ch/>).

Ont été produits spécifiquement pour MQ en sous-traitance les échantillons d'essai interlaboratoire suivants:

B1 Strep A Test, B2 Uricult, H4 Hématologie parasitaire, K14 Marqueur tumoral

Détermination des valeurs-cible

Pour chaque valeur-cible est indiqué le mode de détermination utilisé selon les termes de la norme ISO17043:2010, B2.1 (Colonne "Type"):

- a Valeur connue, sur la base de la production.
- b Valeur de référence certifiée lors de l'utilisation d'échantillons spécifiques
- c Valeur de référence déterminée par analyse
- d „Consensus value“ des laboratoires d'experts
- e „Consensus value“ des participants

Pour les groupes de méthode incluant plus de 9 participants, les valeurs cibles sont déterminées comme étant la „Consensus value“ ("e") des participants. Pour la détermination de ces valeurs cibles est utilisée la moyenne réalisée par le groupe de méthodes. Les résultats qui présentent un écart par rapport à la valeur cible supérieur à 1.5 fois la tolérance Qualab, sont considérés comme résultats aberrants et exclus du calcul de la valeur de référence. Les résultats des essais d'aptitude sont utilisés comme valeur de base pour éliminer les taux aberrants. Afin de mettre à disposition de tous les participants des valeurs-cible les plus pertinentes possibles, d'autres procédures peuvent également être utilisées pour des groupes de méthode plus restreints.

Incertitude dans la détermination des valeurs-cible

L'incertitude-type (u_x) est calculée à l'aide de la formule suivante (ISO13528):

$$u_x = (\text{Valeur-cible}/100) * (1.25/\text{Racine carrée du "nombre des participants"}) * \text{CV en \%}$$

- u_x est exprimée dans la même unité que la valeur-cible
- u_x peut être comparée avec l'écart-type du collectif des participants ($\text{Ecart-type} = \text{Valeur-cible} * \text{CV en \%} / 100$)
- Pour un nombre de participants >18 , l'incertitude-type (u_x) est significativement plus petite que la dispersion du collectif des participants et peut donc être négligée.


Tolérances QUALAB et MQ

Pour les analyses obligatoires sont utilisées les tolérances fixées par Qualab (www.qualab.ch, contrôle de qualité externe). Pour les analyses non-obligatoires, les tolérances sont fixées par le directeur de MQ pilotant l'essai interlaboratoire.

Si l'incertitude déterminée de la valeur de référence u_x est supérieure à 15% de la tolérance QUALAB ou de MQ, la lettre qui caractérise le type de détermination de la valeur-cible est en outre marquée d'une étoile (par exemple "e*"). Nous rendons ainsi les participants attentifs au fait que l'incertitude de la valeur de référence peut avoir une influence sur l'évaluation.

Représentation graphique

La représentation graphique des résultats est la suivante:

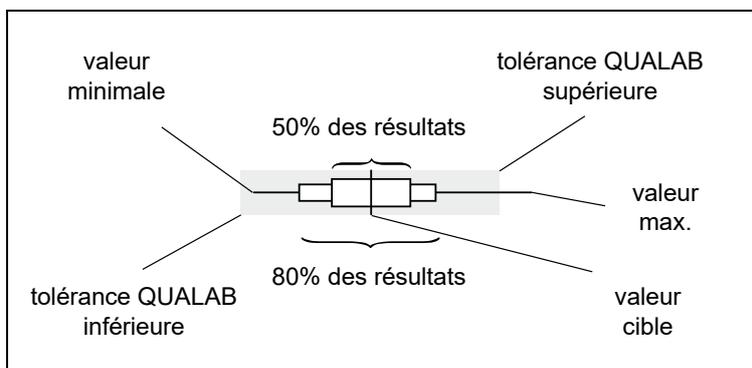

Comparaison des appareils

Les données de ce rapport vous permettent de comparer les performances respectives des divers appareils. Toutefois, vous devez tenir compte des points suivants:

- Le contrôle Chimie K1 est un sérum de contrôle commercialisé prêt à l'emploi. Même si l'échantillon est d'origine humaine, des effets matriciels sont possibles. Ceux-ci dépendent de l'appareil et peuvent générer des valeurs cible différentes.
- Seul un échantillon a été mesuré. La dispersion des résultats étant dépendante de la nature de l'échantillon (effets matriciels) et du niveau du résultat, les coefficients de variation déterminés (CV en %) ne sont pas toujours valables.
- Une grande partie des taux aberrants est due à des erreurs administratives (erreur d'unité, confusion des résultats) ou à des erreurs de manipulation (erreur d'échantillon, dissolution incorrecte, mélange insuffisant) et n'a rien à voir avec le type d'appareil.


Zürich, 1.10.2019



Dr. R. Fried
Directeur de l'essai interlaboratoire


Il n'est pas autorisé de publier une partie ou l'intégralité de ce rapport sans notre accord écrit préalable. L'original est conservé dans les archives sous www.mqzh.ch.

Quick OA

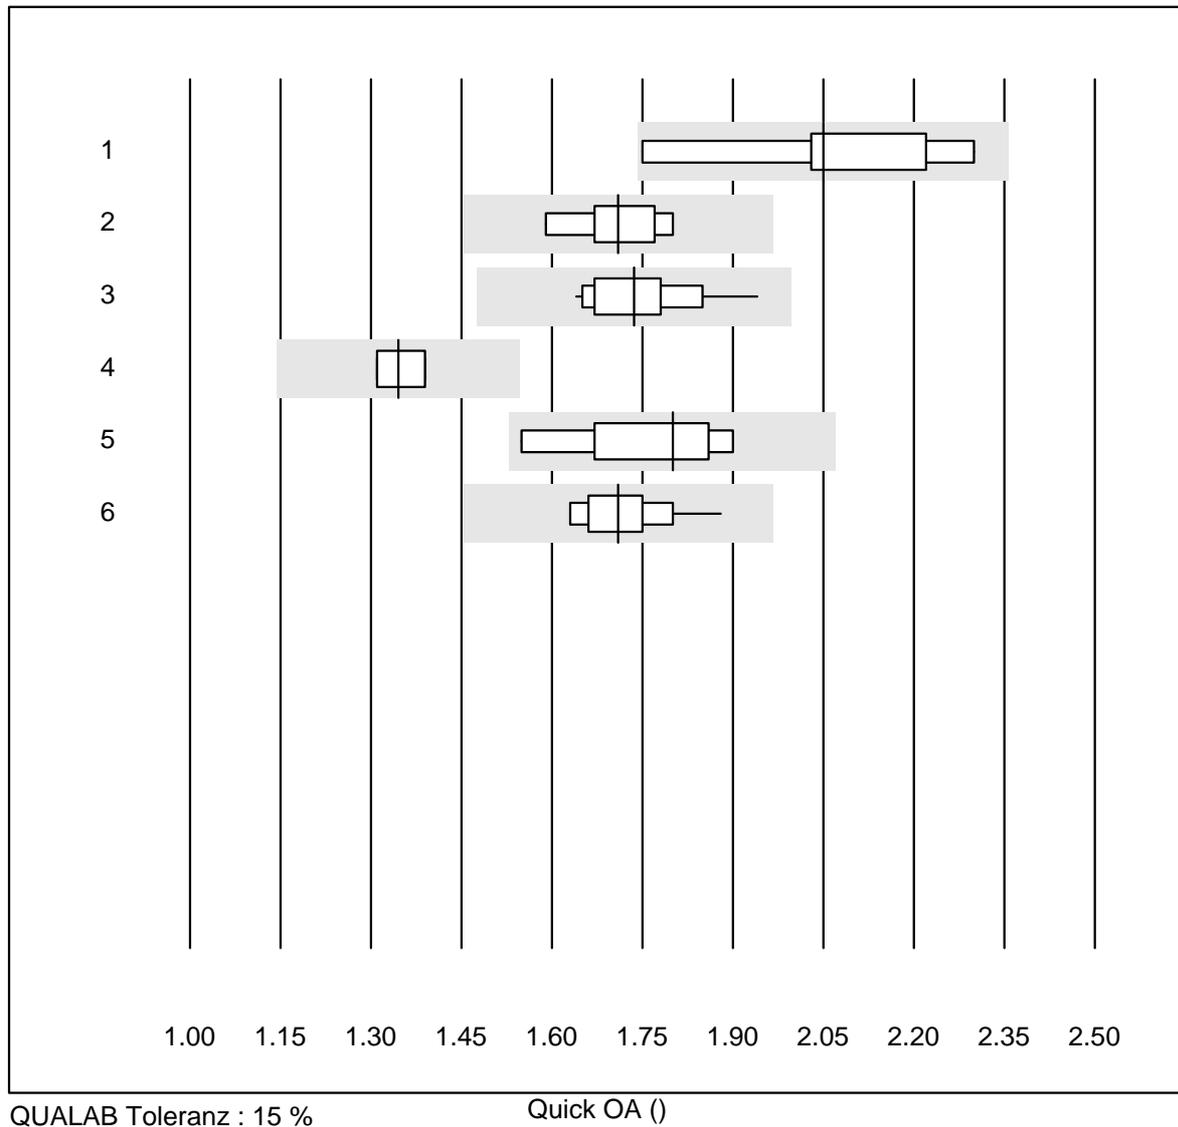


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Neoplastin Plus	7	100.0	0.0	0.0	2.05	8.5	e*
2	Innovin	10	100.0	0.0	0.0	1.71	3.8	e
3	Recombiplastin 2G	14	100.0	0.0	0.0	1.74	4.9	e
4	Eurolyser	4	75.0	0.0	25.0	1.35	3.2	e
5	Autres méthodes	9	100.0	0.0	0.0	1.80	6.6	e*
6	Neoplastin R	10	100.0	0.0	0.0	1.71	4.6	e

Fibrinogène OA

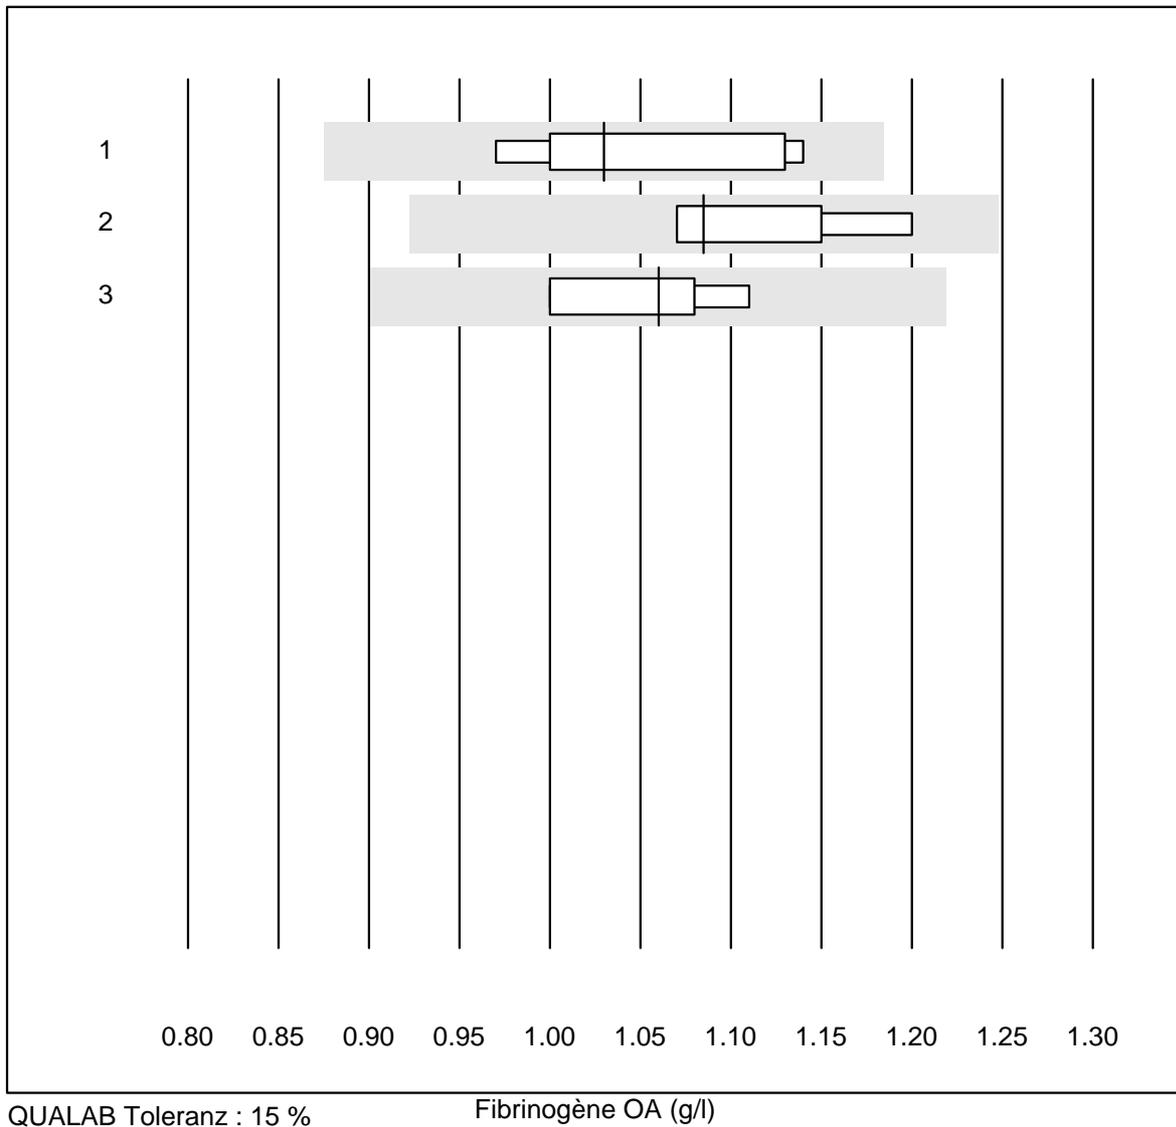


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Autres méthodes	7	100.0	0.0	0.0	1.03	6.3	e*
2 Stago/STA	12	100.0	0.0	0.0	1.09	4.0	e
3 Fibrinogen Q.F.A.	5	100.0	0.0	0.0	1.06	4.7	e*

aPTT OA

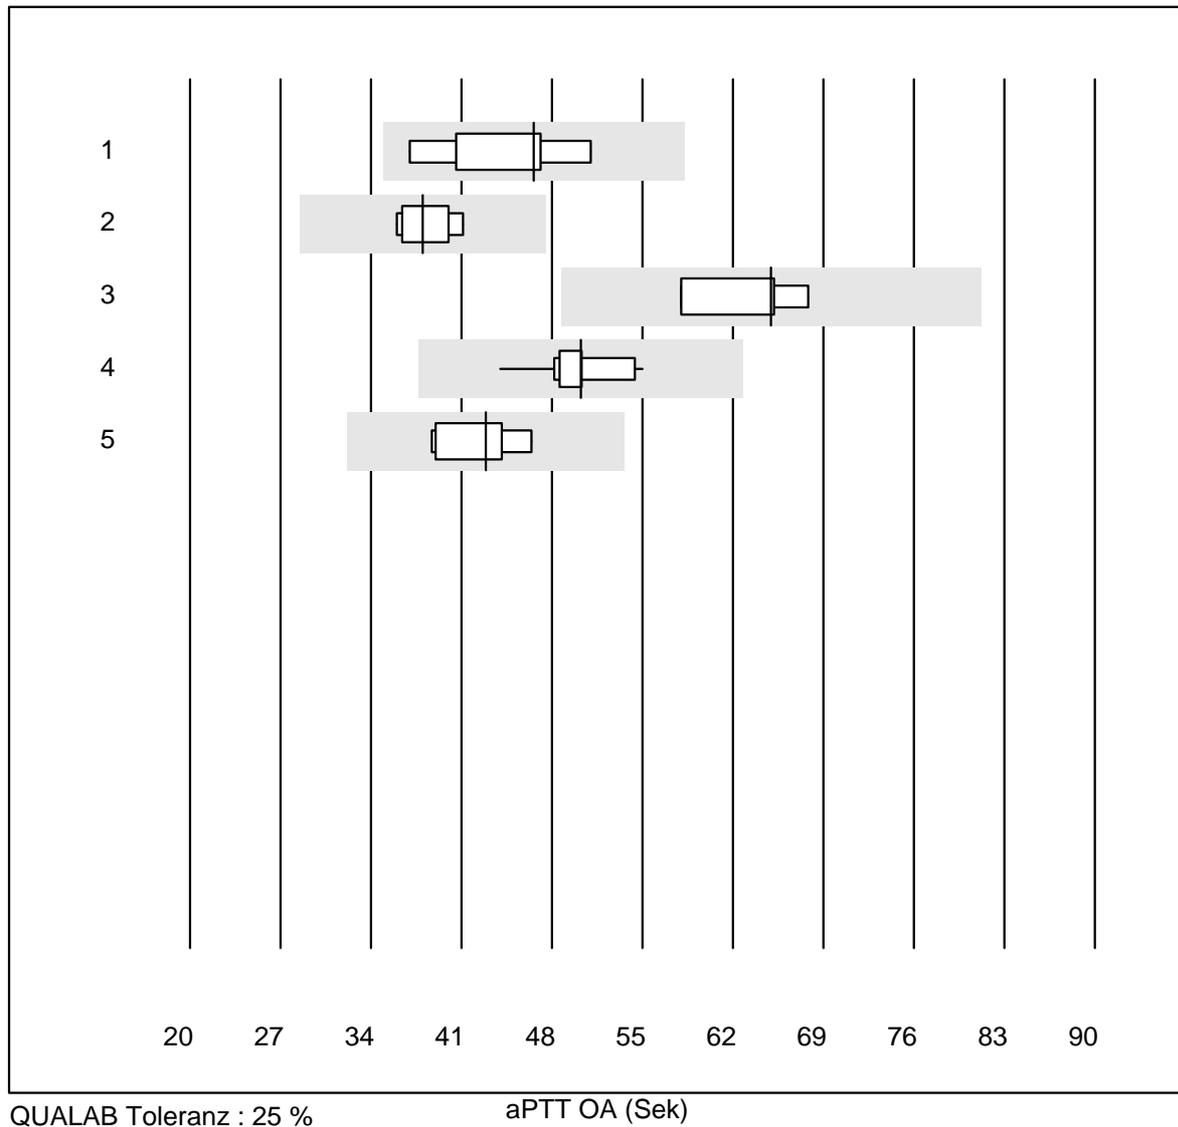

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Autres méthodes	7	100.0	0.0	0.0	46.6	10.4	e*
2 Actin FS	6	100.0	0.0	0.0	38.0	5.5	e
3 Pathromtin SL	4	100.0	0.0	0.0	65.0	6.5	e*
4 Stago/STA	12	100.0	0.0	0.0	50.3	6.1	e
5 aPTT-SP	8	100.0	0.0	0.0	42.9	6.5	e

INR CoaguChek

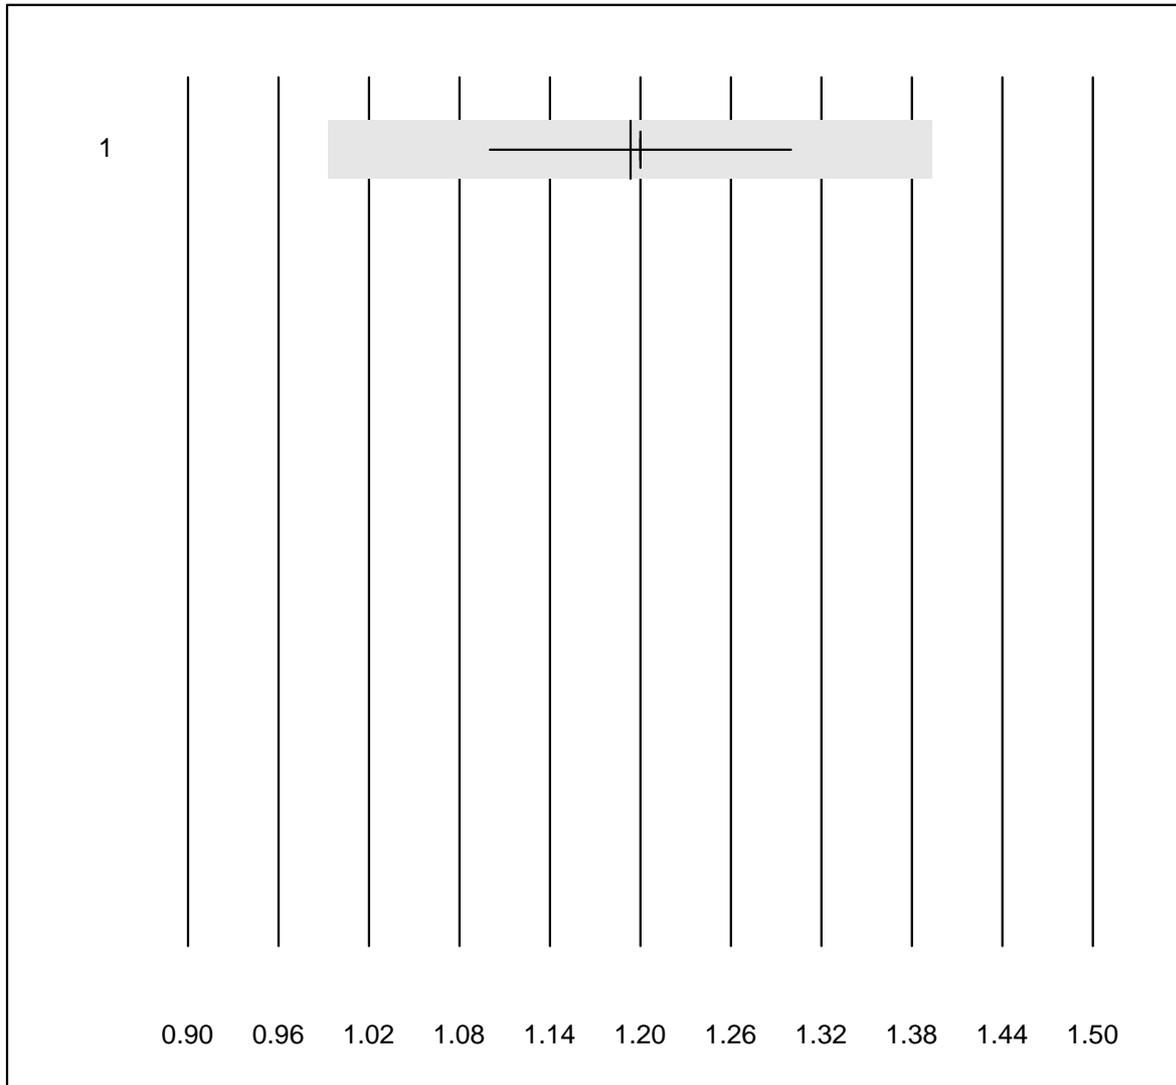


QUALAB Toleranz : 15 %
(< 1.3: +/- 0.2)

INR CoaguChek ()


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	CoaguChek Pro II	458	99.1	0.0	0.9	1.2	2.2	e

Quick N

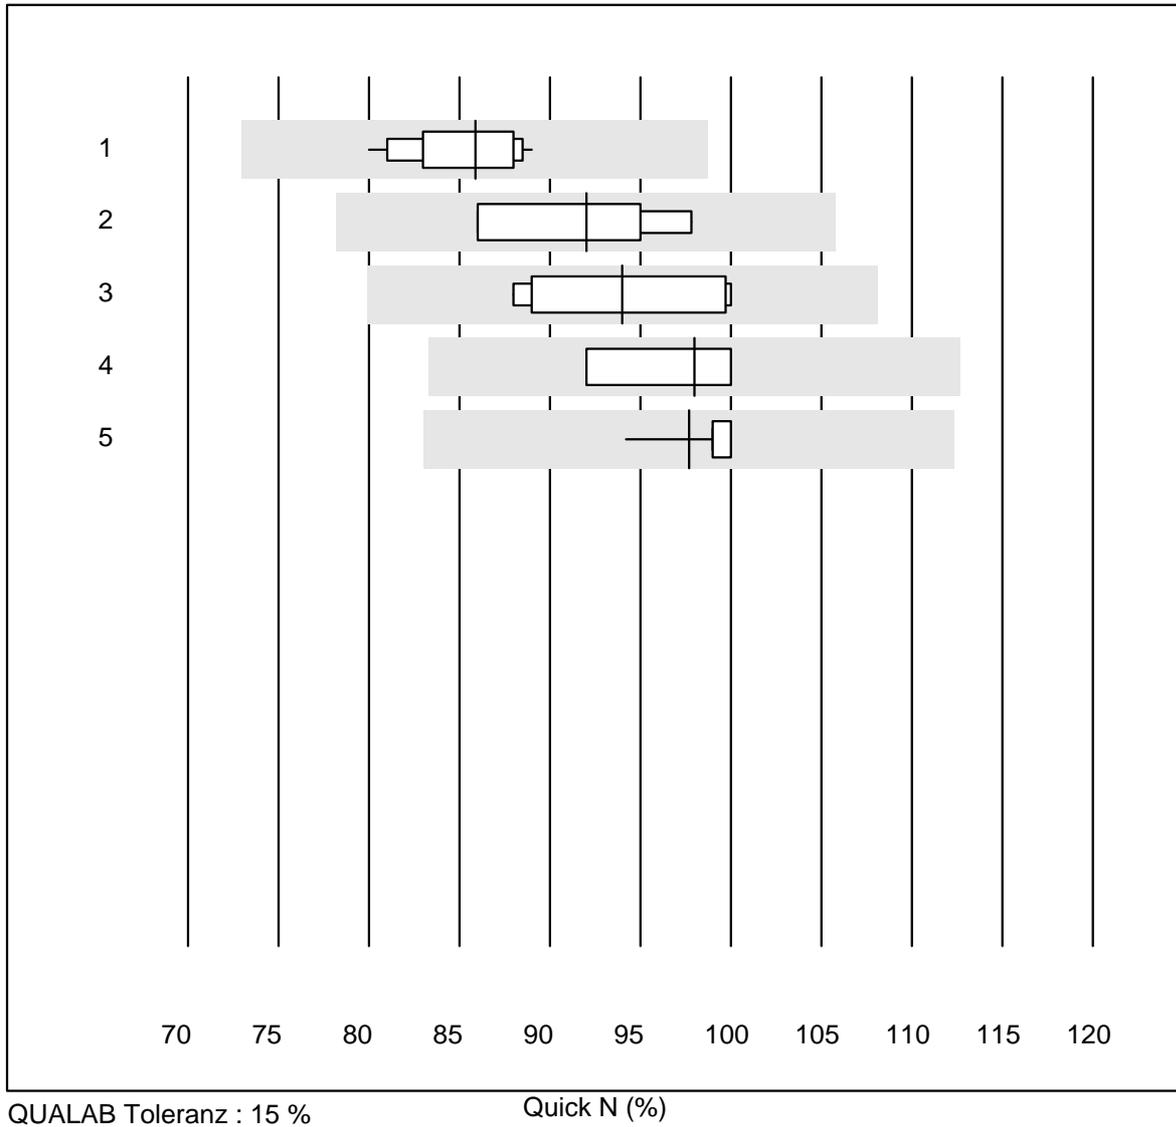


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Neoplastin R	13	100.0	0.0	0.0	86	3.6	e
2 Neoplastin Plus	7	100.0	0.0	0.0	92	4.8	e*
3 Innovin	7	85.7	0.0	14.3	94	5.4	e*
4 toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	98	3.7	e
5 Recombiplastin 2G	11	100.0	0.0	0.0	98	1.7	e

Faktor II

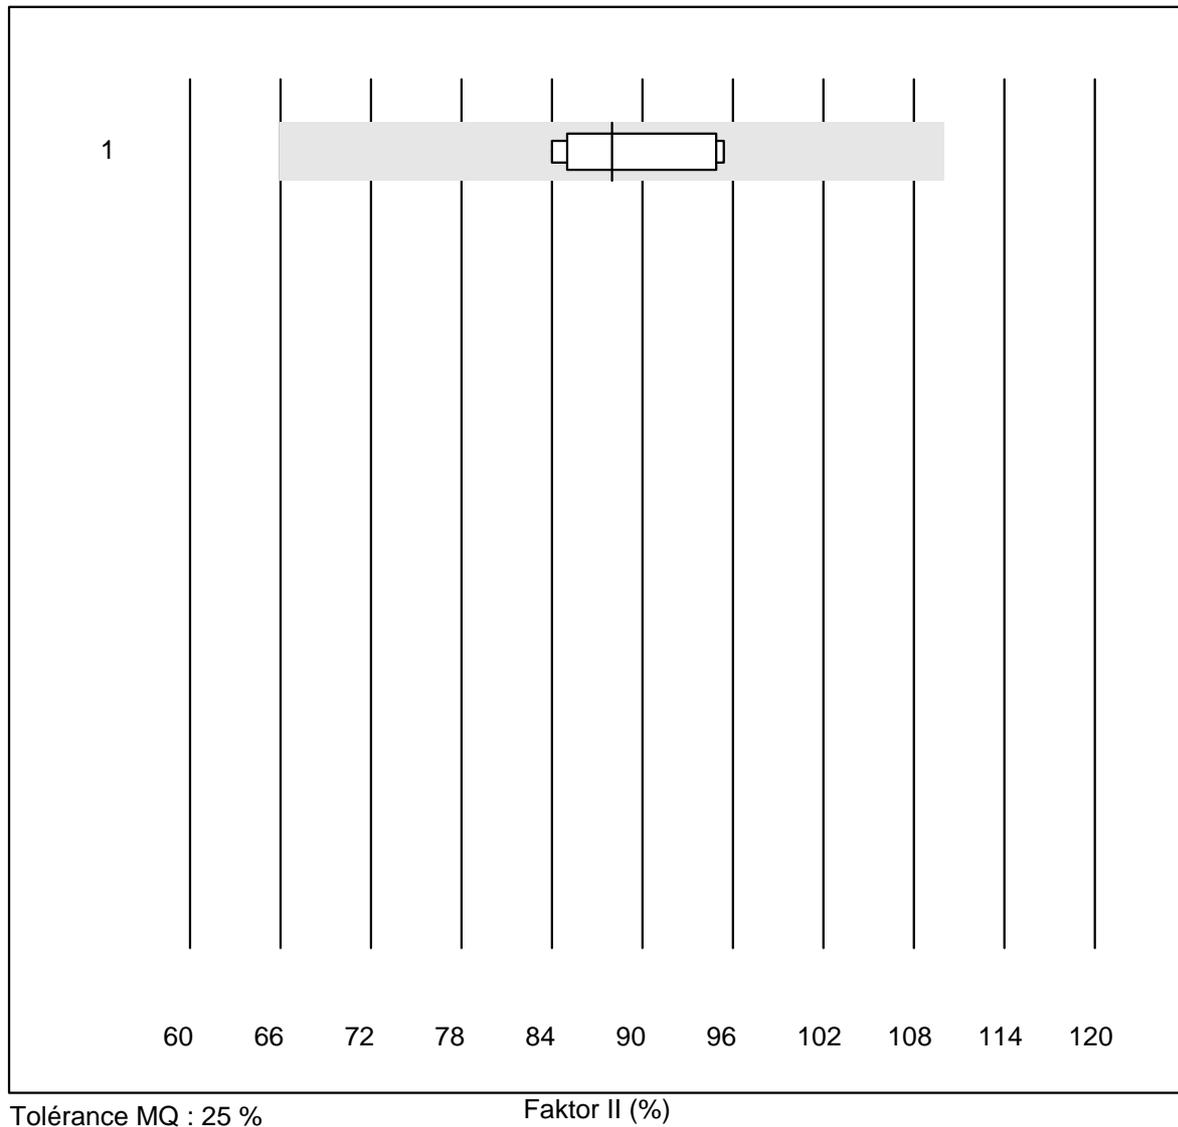


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	88.0	6.0	a

Fibrinogen N

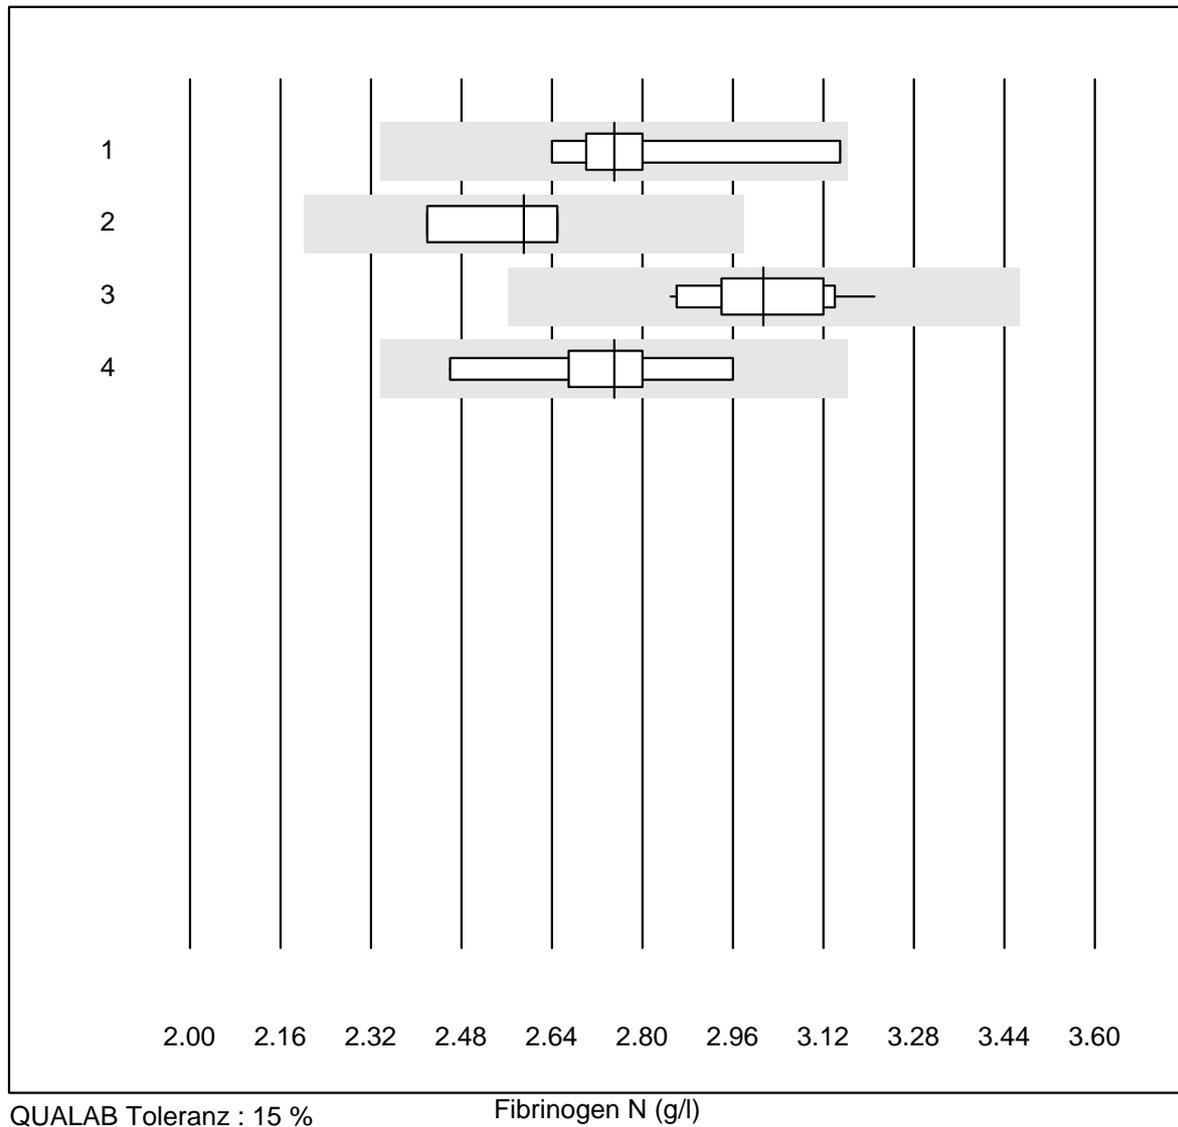

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Siemens Thrombin	6	100.0	0.0	0.0	2.75	6.5	e*
2 Autres méthodes	4	75.0	0.0	25.0	2.59	4.5	e*
3 Stago/STA	15	100.0	0.0	0.0	3.01	3.6	e
4 Fibrinogen Q.F.A.	9	100.0	0.0	0.0	2.75	5.5	e*

Faktor V

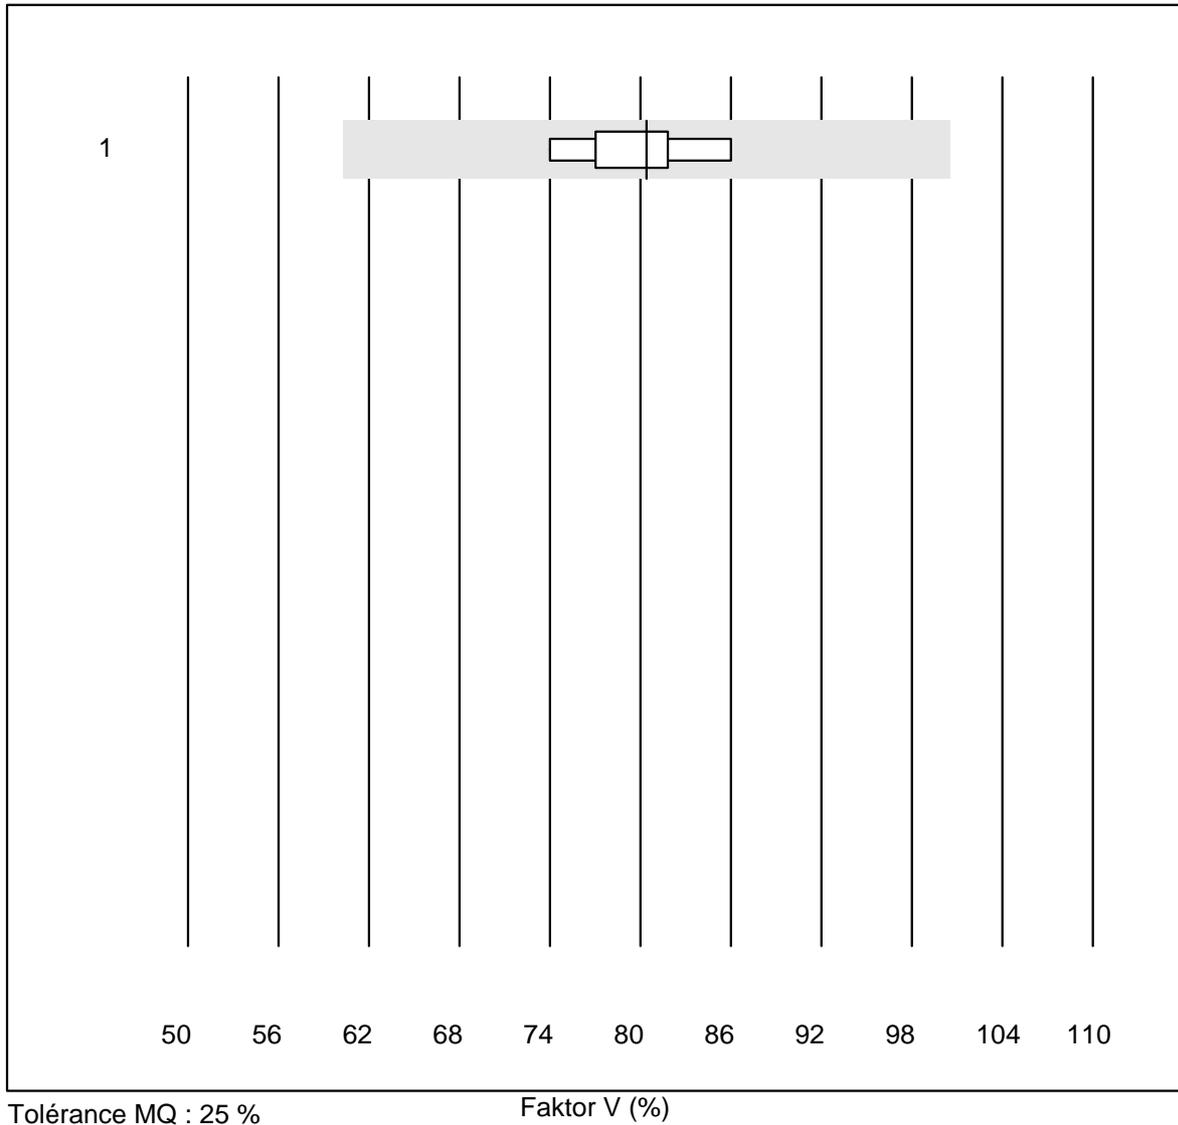


Tolérance MQ : 25 %

Faktor V (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	80.4	5.7	a

aPTT N

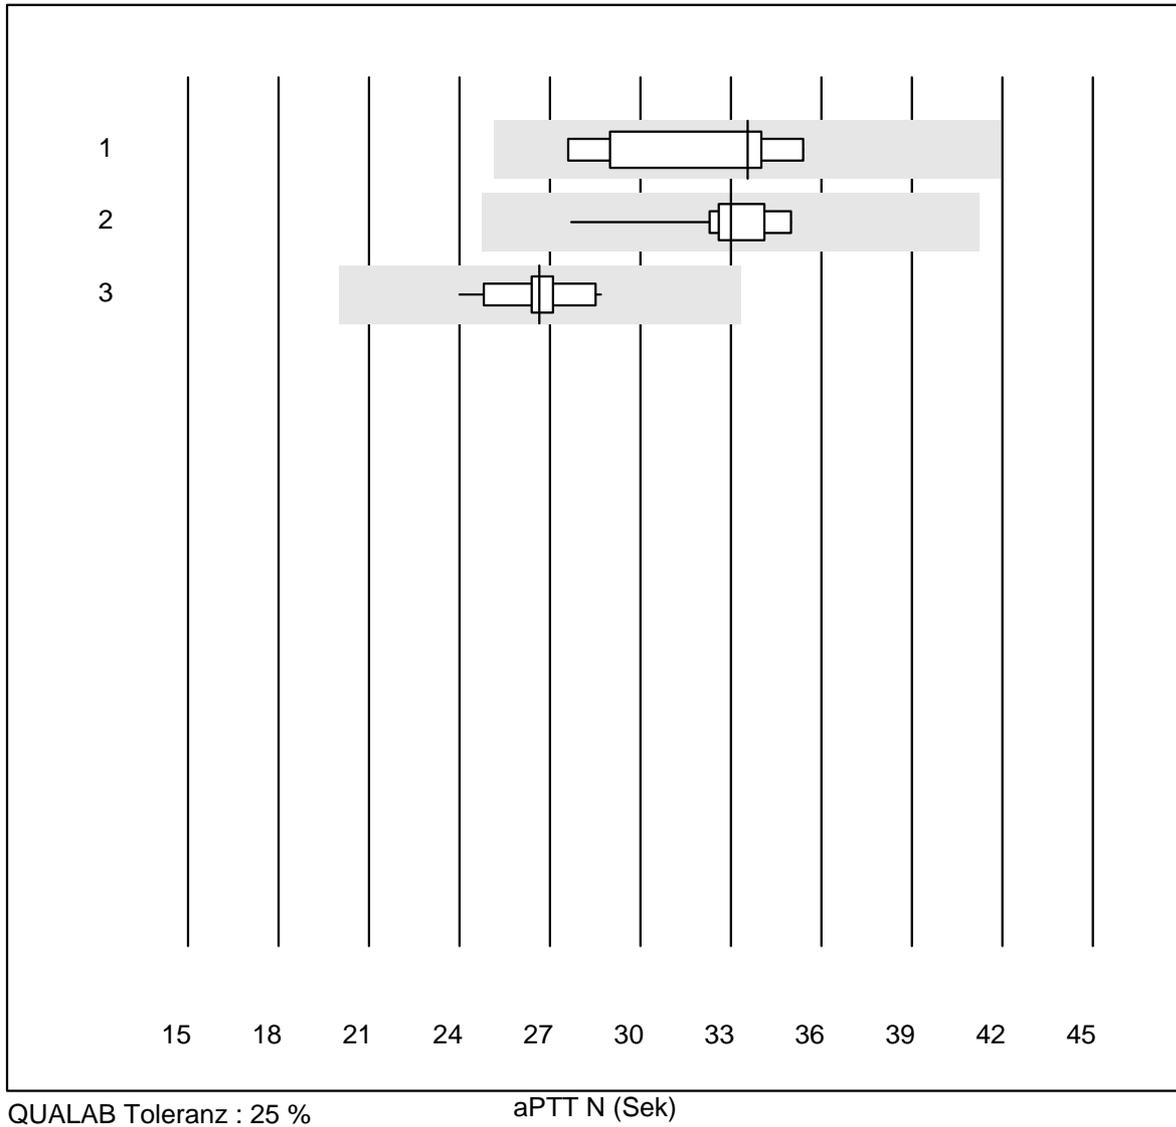


QUALAB Toleranz : 25 %

aPTT N (Sek)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Autres méthodes	8	100.0	0.0	0.0	33.6	8.6	e*
2 Stago/STA	14	100.0	0.0	0.0	33.0	5.4	e
3 aPTT-SP	14	100.0	0.0	0.0	26.7	5.0	e

Faktor VII

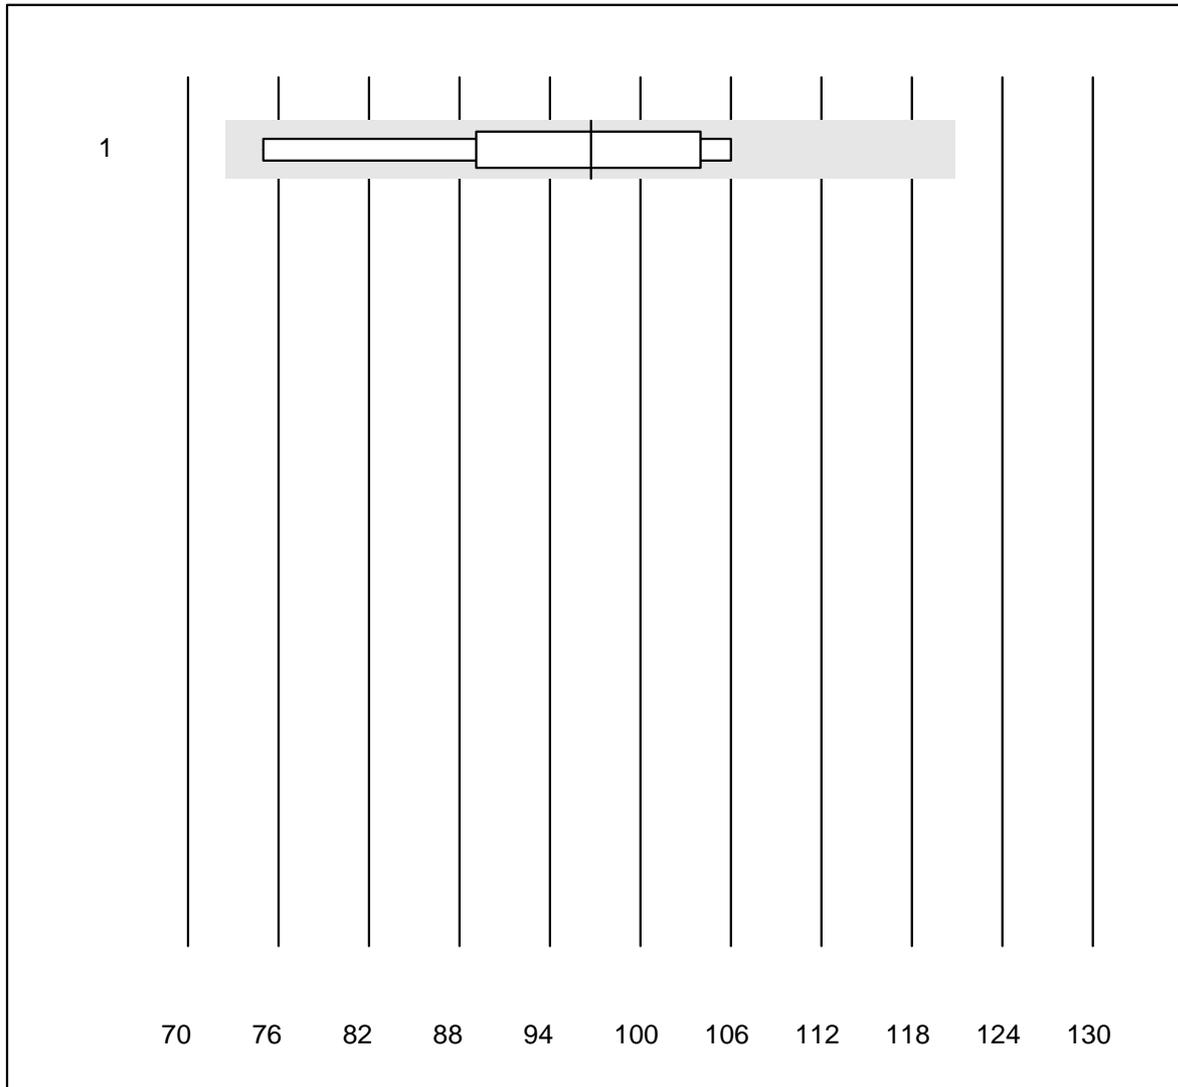


Tolérance MQ : 25 %

Faktor VII (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	96.7	13.4	a

Quick H

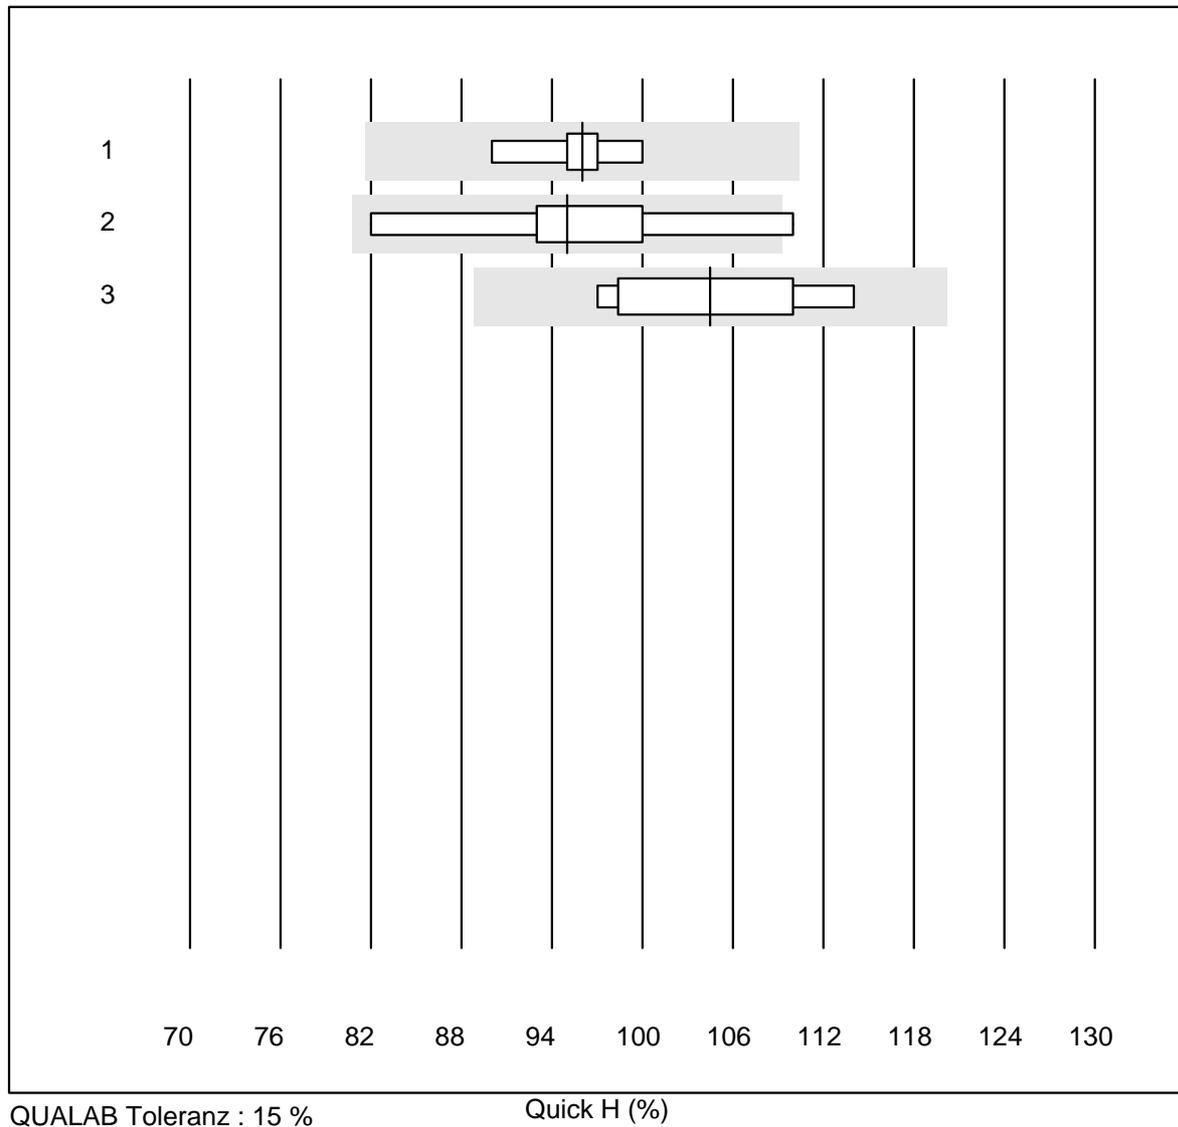


QUALAB Toleranz : 15 %

Quick H (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Neoplastin R	8	100.0	0.0	0.0	96	2.9	e
2	toutes les méthodes	9	88.9	11.1	0.0	95	7.9	e*
3	Recombiplastin 2G	6	100.0	0.0	0.0	105	6.2	e*

Anti-FXa (unfrakt-Heparin)

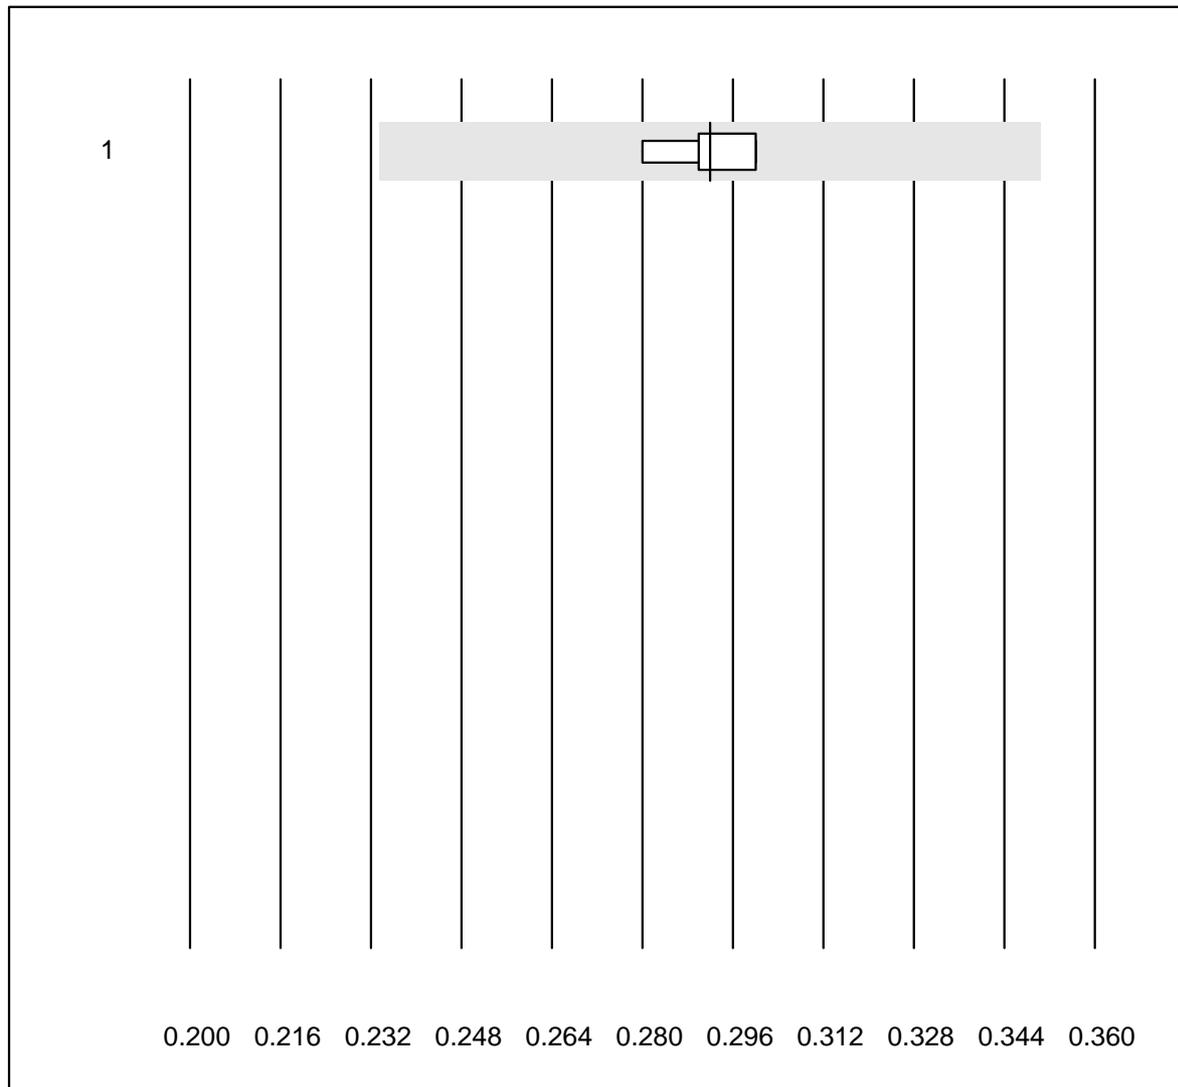


Tolérance MQ : 20 %

Anti-FXa (unfrakt-Heparin) (IU/ml)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ACL	5	100.0	0.0	0.0	0.29	2.9	a

Fibrinogen H

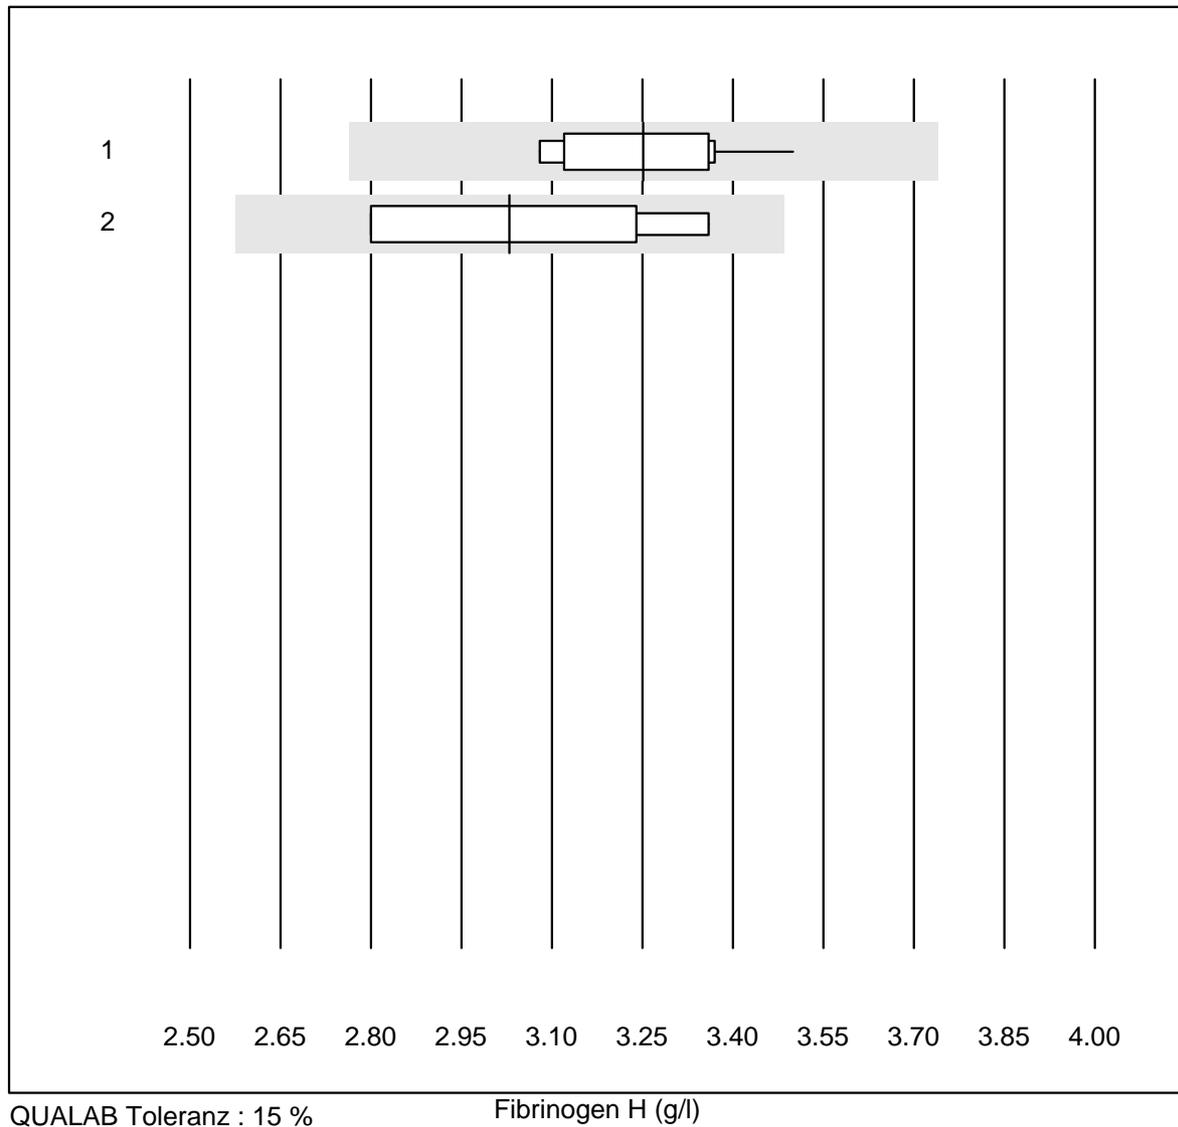

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Stago/STA	11	100.0	0.0	0.0	3.25	4.2	e
2 Fibrinogen Q.F.A.	5	100.0	0.0	0.0	3.03	8.3	e*

aPTT H

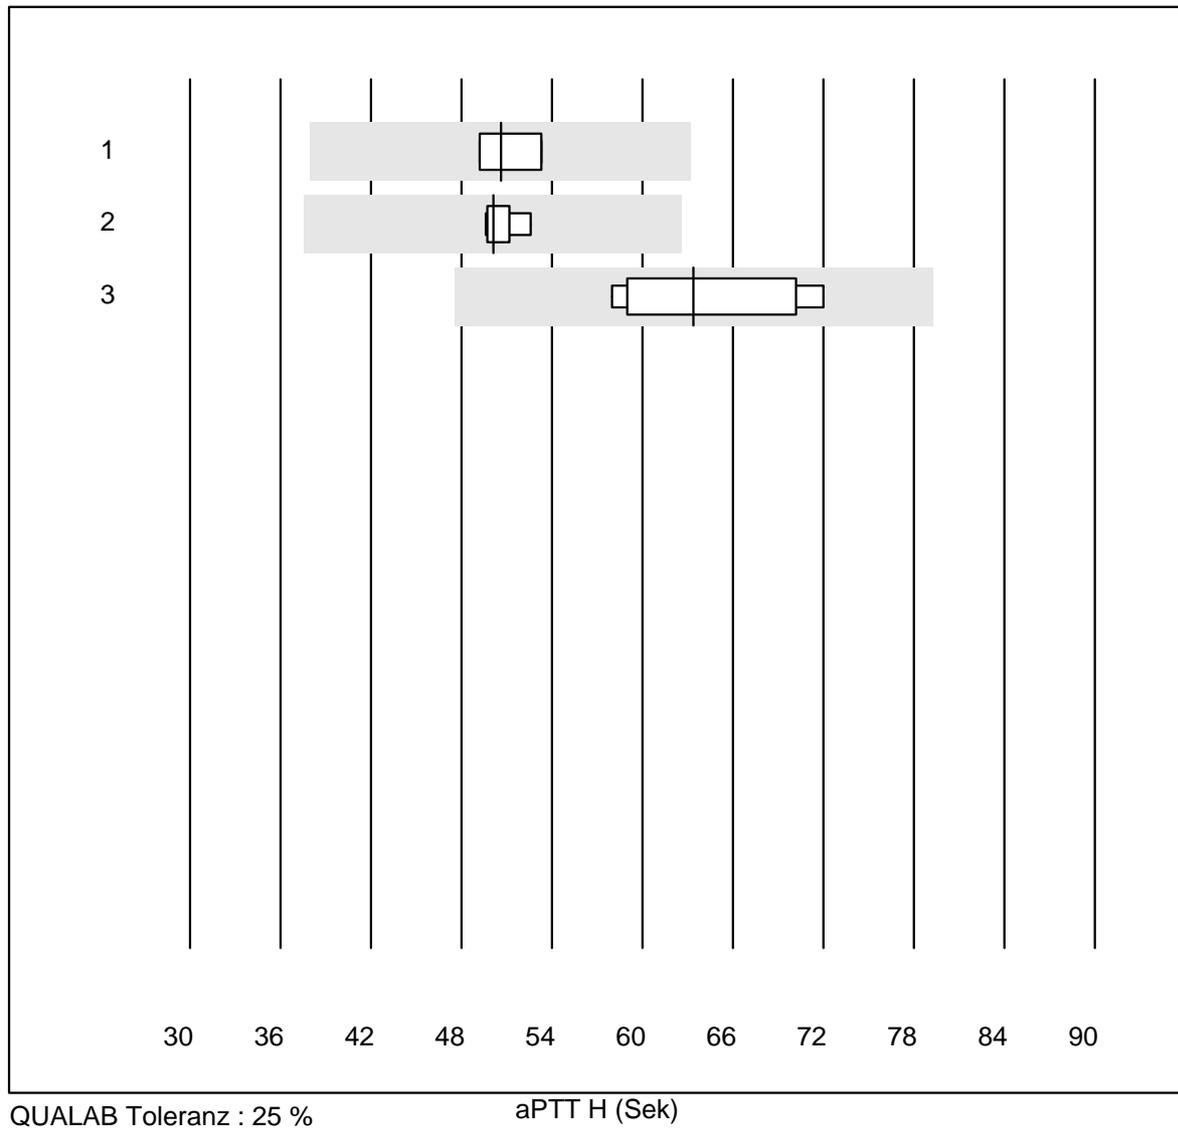


QUALAB Toleranz : 25 %

aPTT H (Sek)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Autres méthodes	4	75.0	0.0	25.0	50.6	4.6	a
2 Stago/STA	7	100.0	0.0	0.0	50.1	2.1	e
3 aPTT-SP	6	100.0	0.0	0.0	63.4	9.6	a

D-Dimères NC

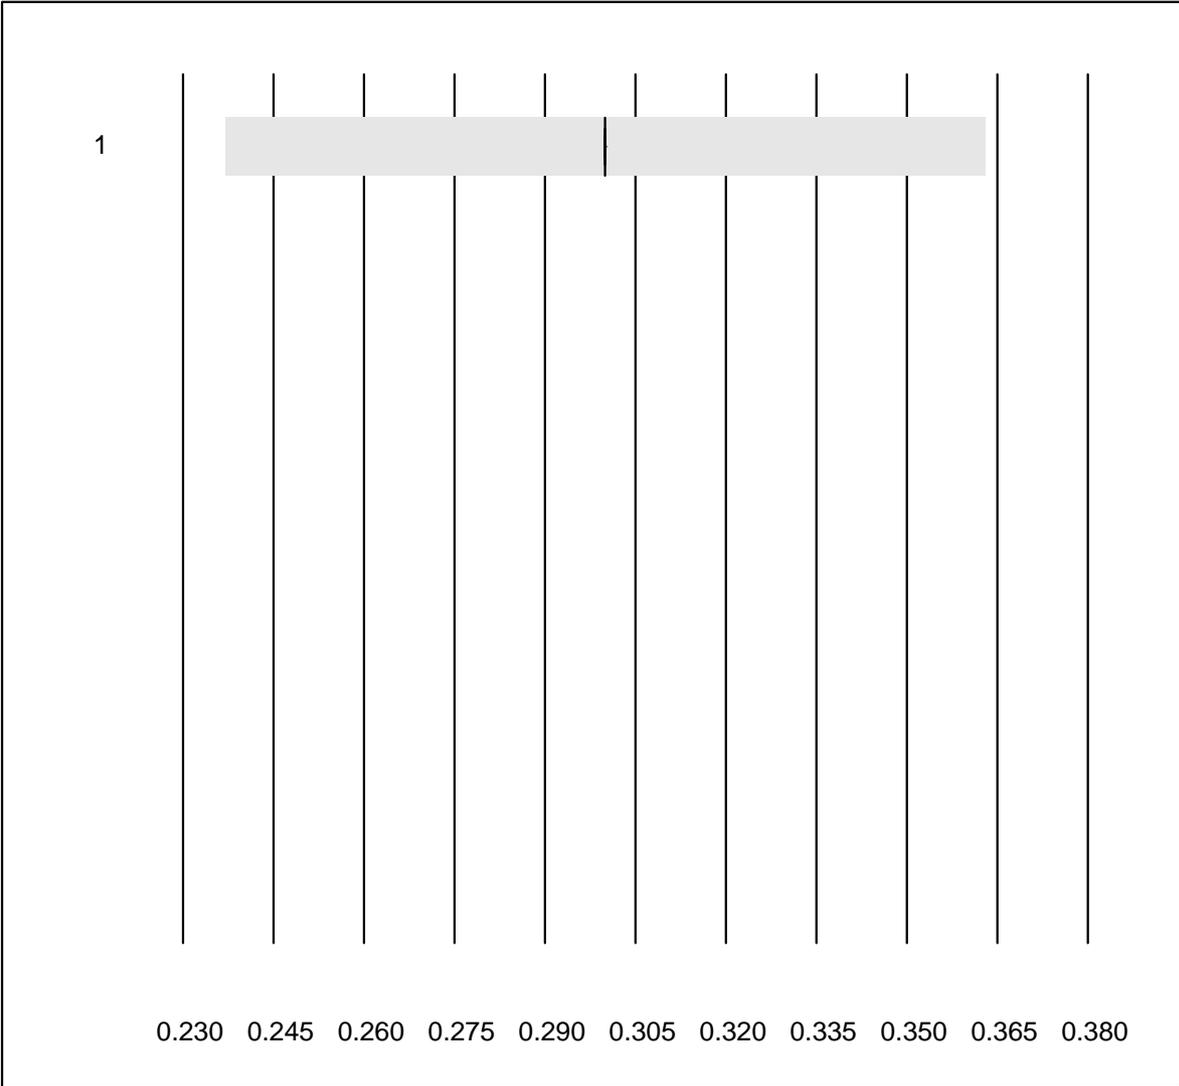


QUALAB Toleranz : 21 %

D-Dimères NC (mg/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	NycoCard	8	37.5	0.0	62.5	0.30	0.0	e

D-Dimères

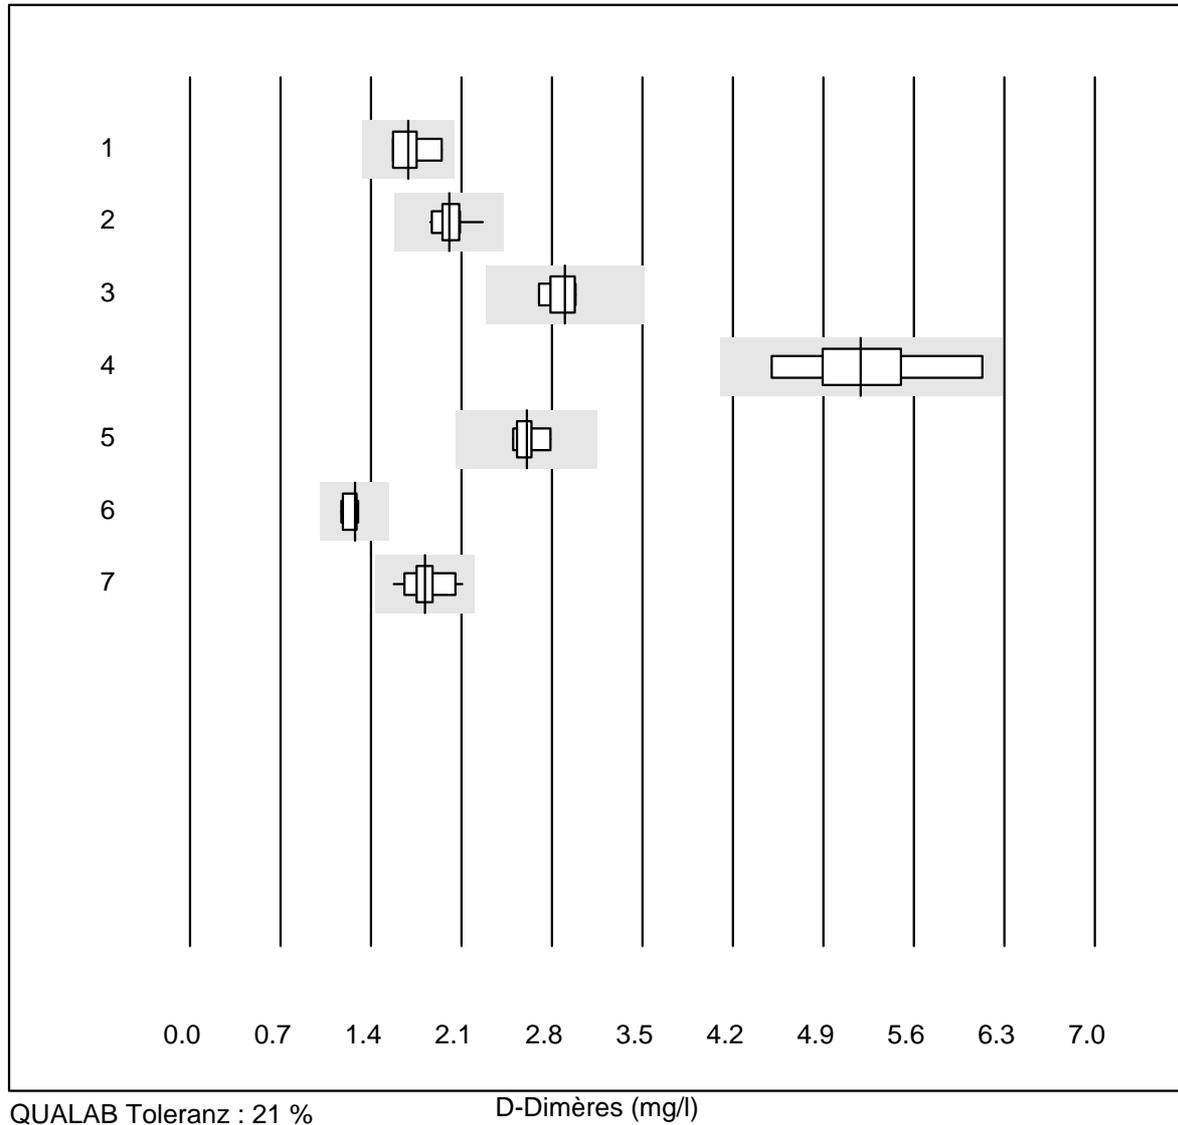


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas (Heparinplasma	4	100.0	0.0	0.0	1.69	9.6	e*
2	STA Liatest	11	100.0	0.0	0.0	2.00	5.6	e
3	Siemens Innovance	5	100.0	0.0	0.0	2.90	4.3	e
4	Eurolyser	10	90.0	0.0	10.0	5.19	10.7	e*
5	ACL	7	100.0	0.0	0.0	2.61	3.6	e
6	AQT 90 FLEX	8	100.0	0.0	0.0	1.28	4.1	e
7	VIDAS	18	94.4	0.0	5.6	1.82	7.1	e

CoaguChek APTT

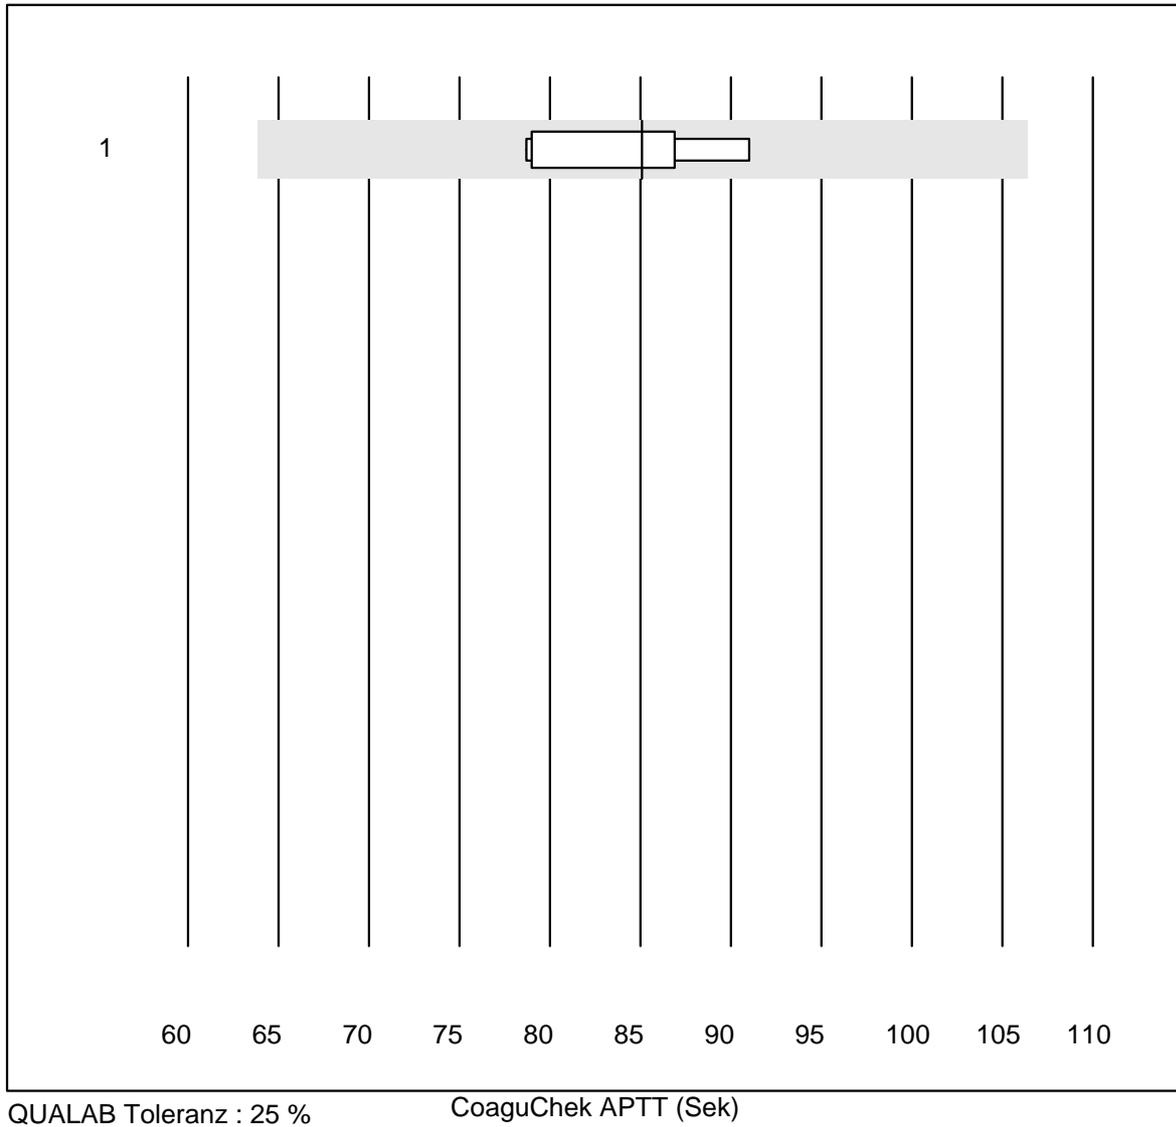

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	CoaguChek Pro II	8	100.0	0.0	0.0	85.1	5.5	e

INR CCXS

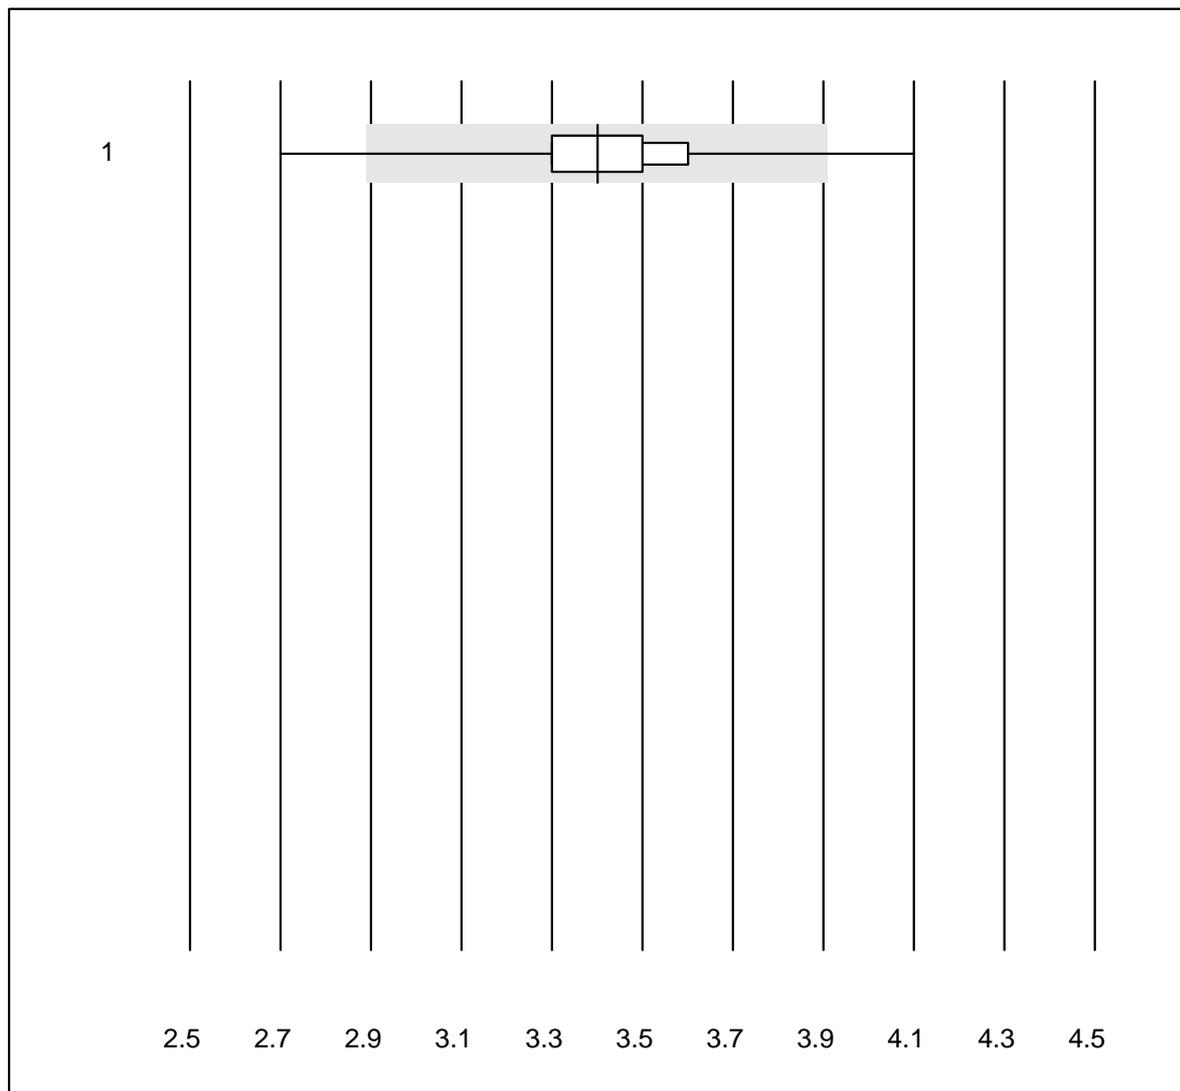


QUALAB Toleranz : 15 %

INR CCXS ()


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	CoaguChek XS	1902	97.1	1.8	1.1	3.4	5.0	e

INR HC

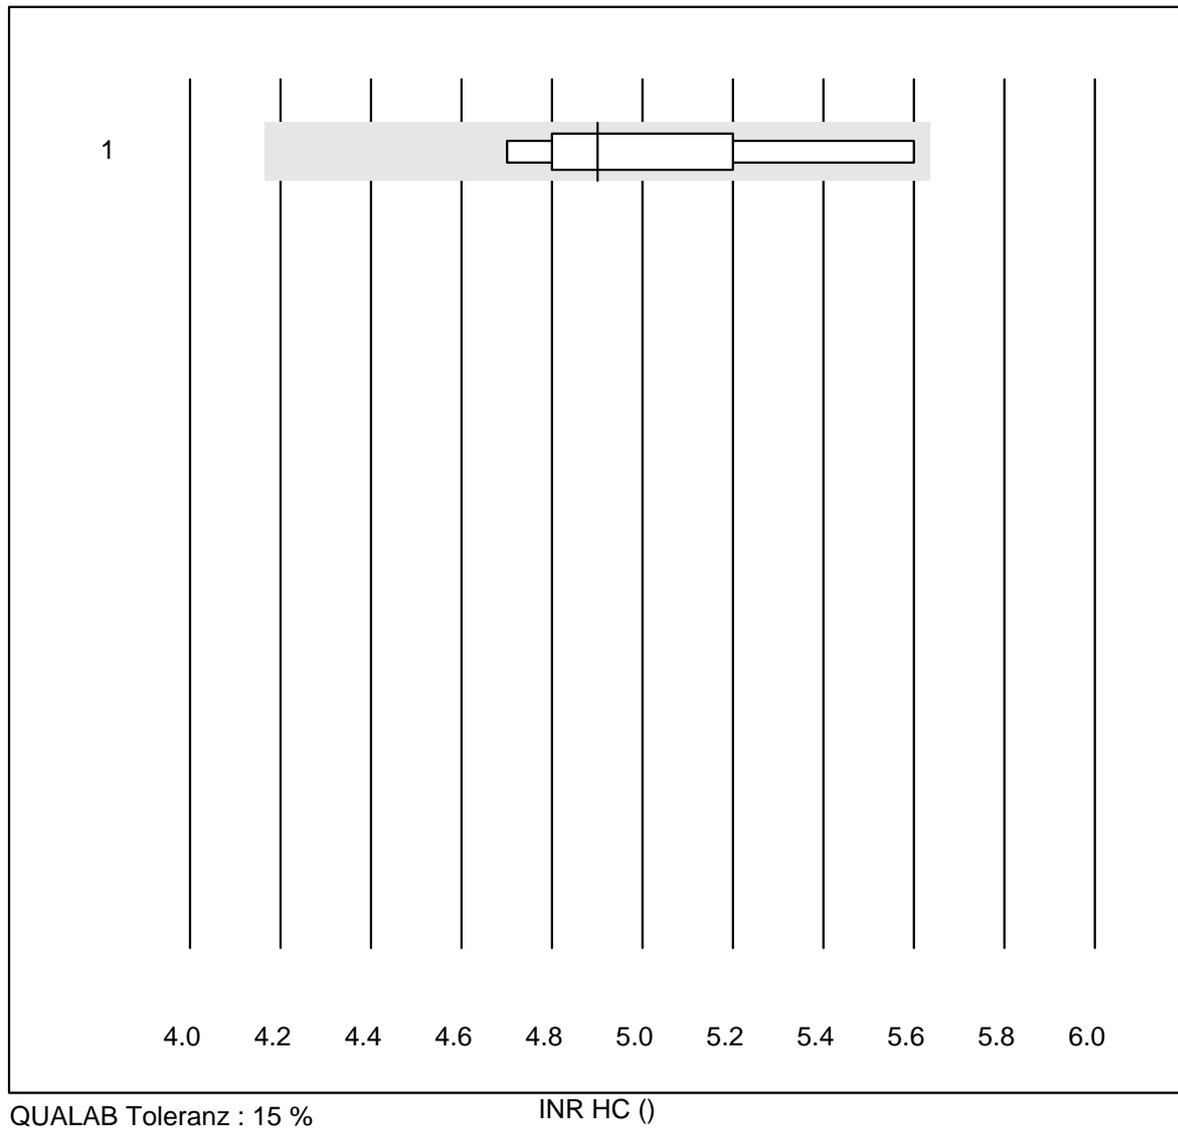

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Hemochron j.	9	100.0	0.0	0.0	4.9	6.3	e*

INR MI

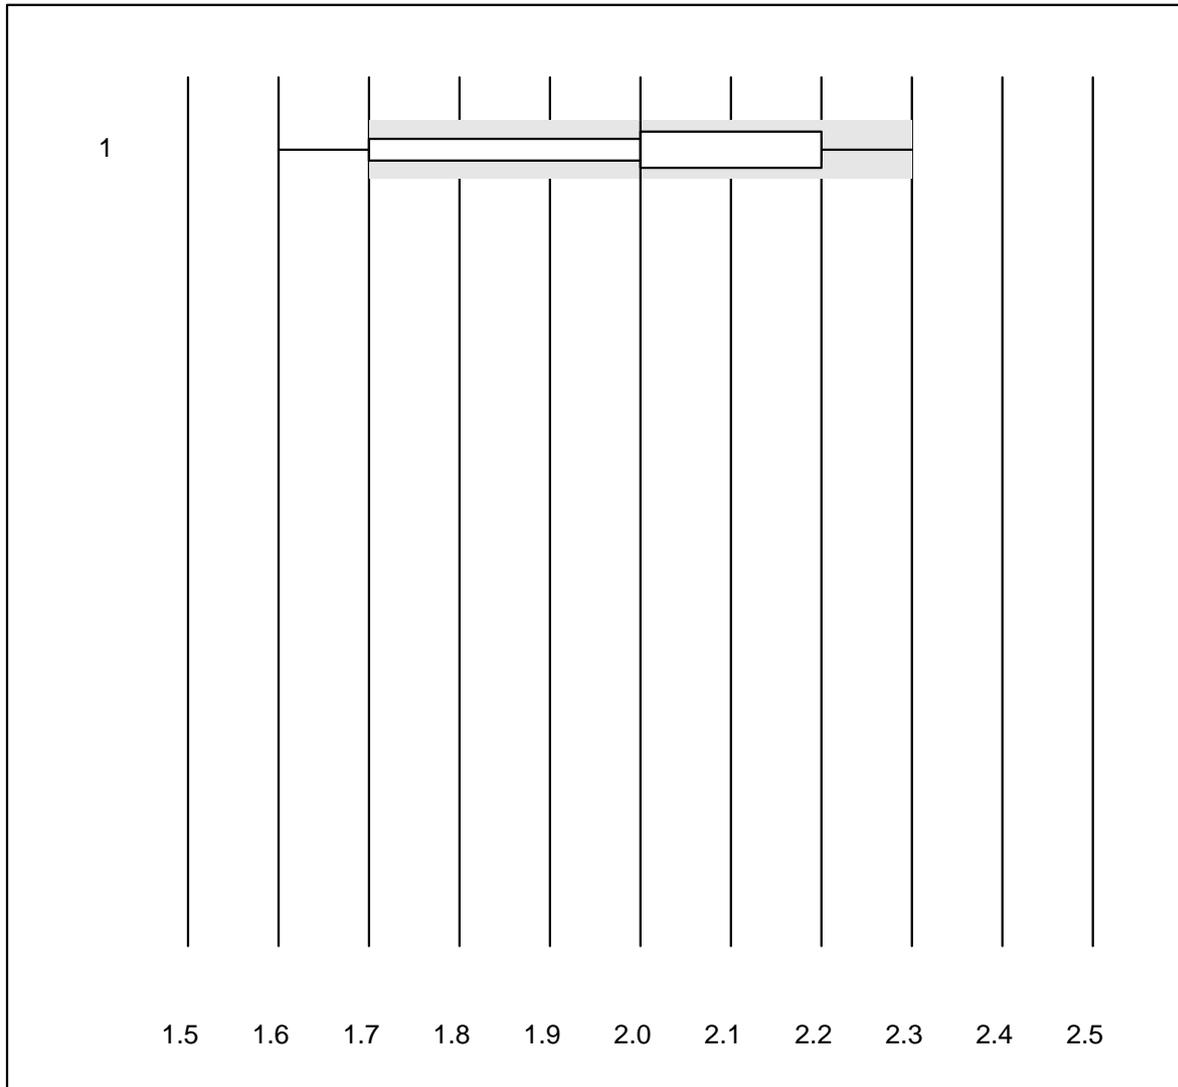


QUALAB Toleranz : 15 %

INR MI ()

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 MicroINR	119	70.6	16.0	13.4	2.0	9.0	e

INR Xprecia

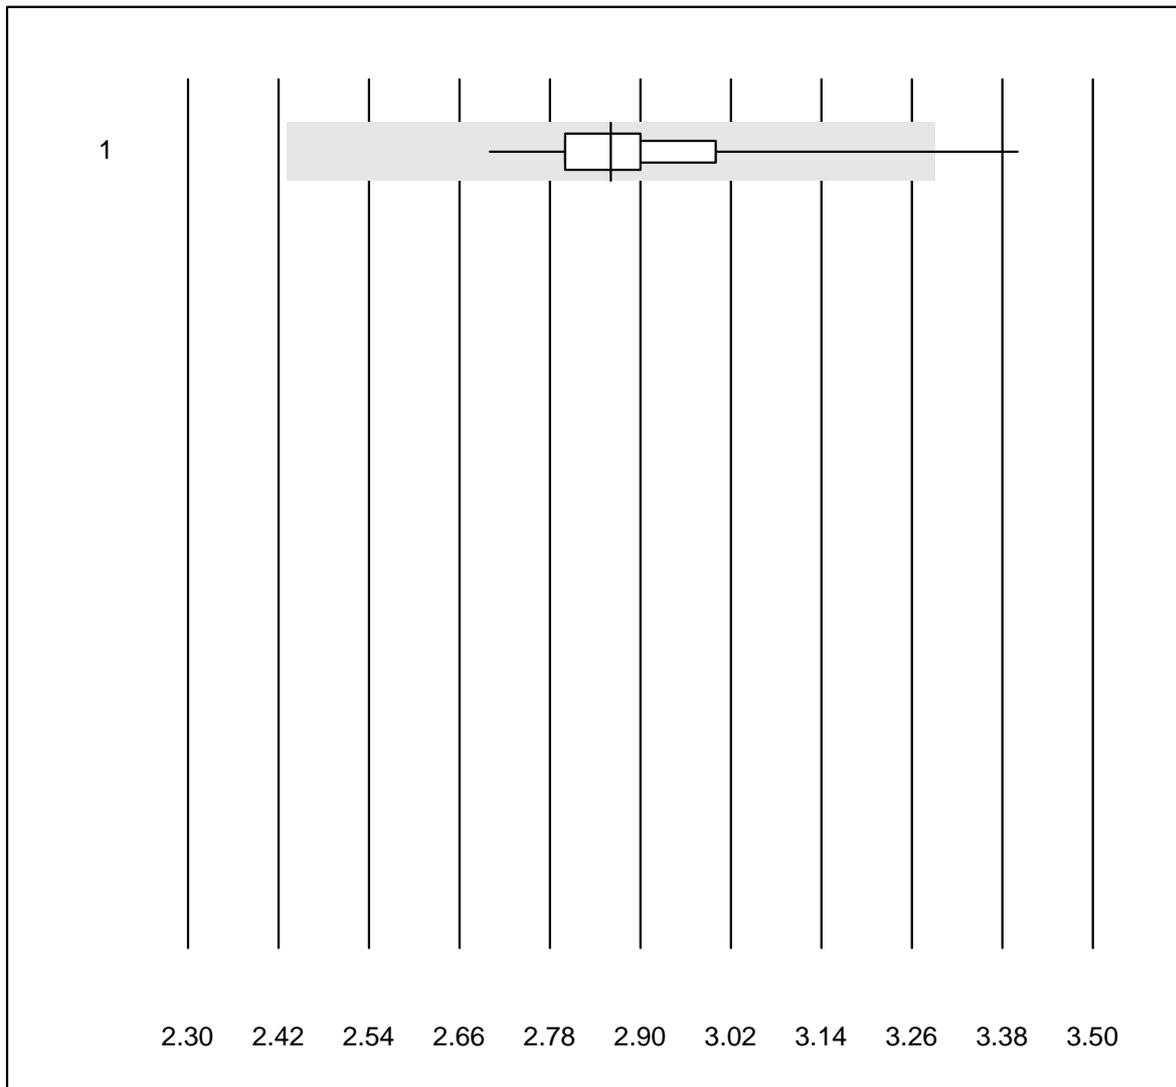


QUALAB Toleranz : 15 %

INR Xprecia ()

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Xprecia	61	98.4	1.6	0.0	2.9	4.3	e

Anti-FXa (LMW-Heparin)

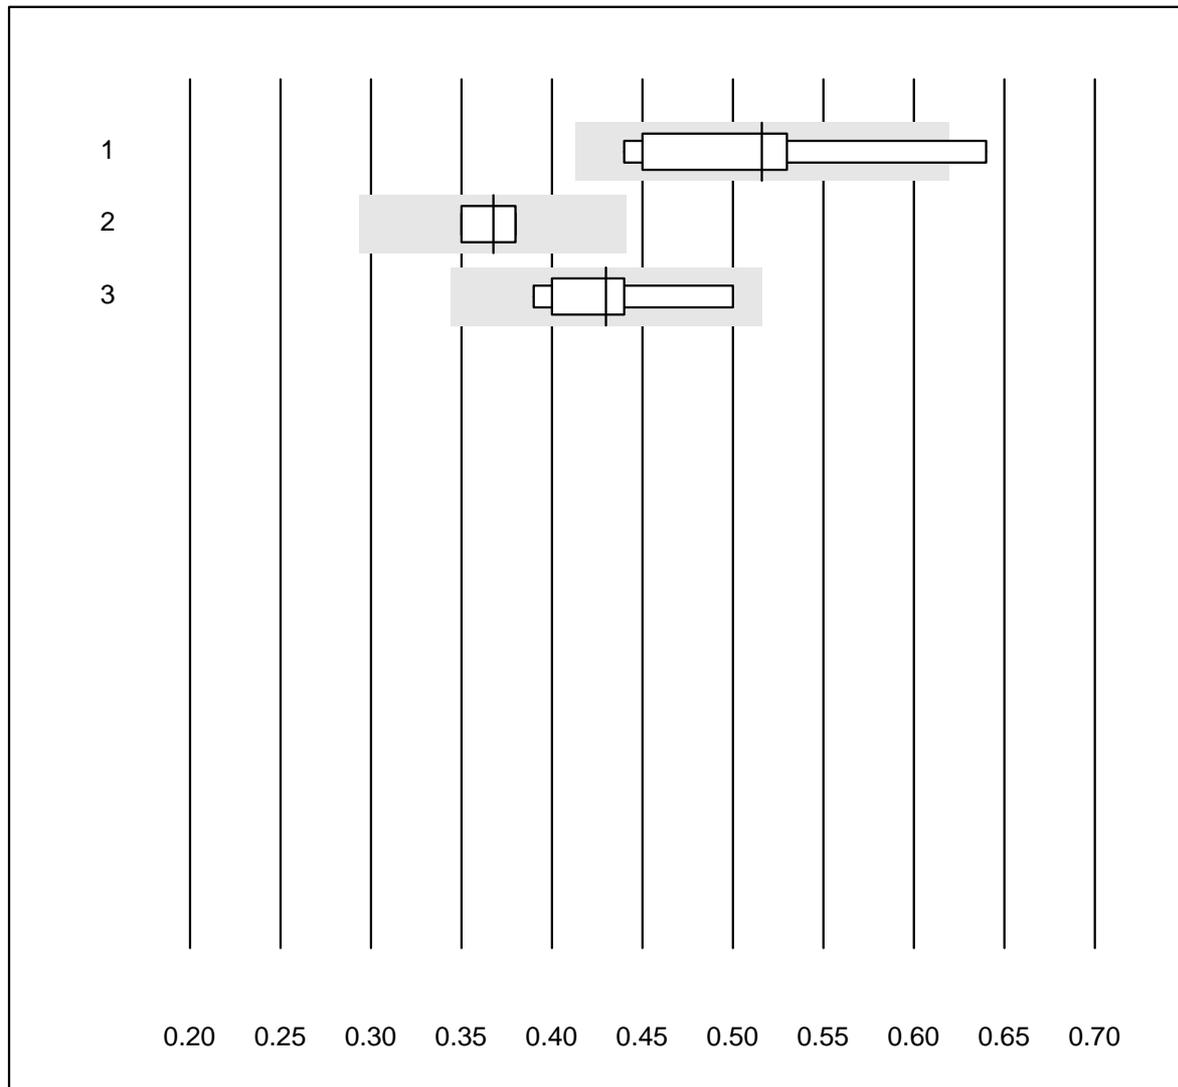


Tolérance MQ : 20 %

Anti-FXa (LMW-Heparin) (E/ml)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	5	80.0	20.0	0.0	0.52	15.5	a
2	Stago/STA	4	100.0	0.0	0.0	0.37	4.1	a
3	ACL	6	100.0	0.0	0.0	0.43	9.1	a

Anti-FXa (Rivaroxaban)

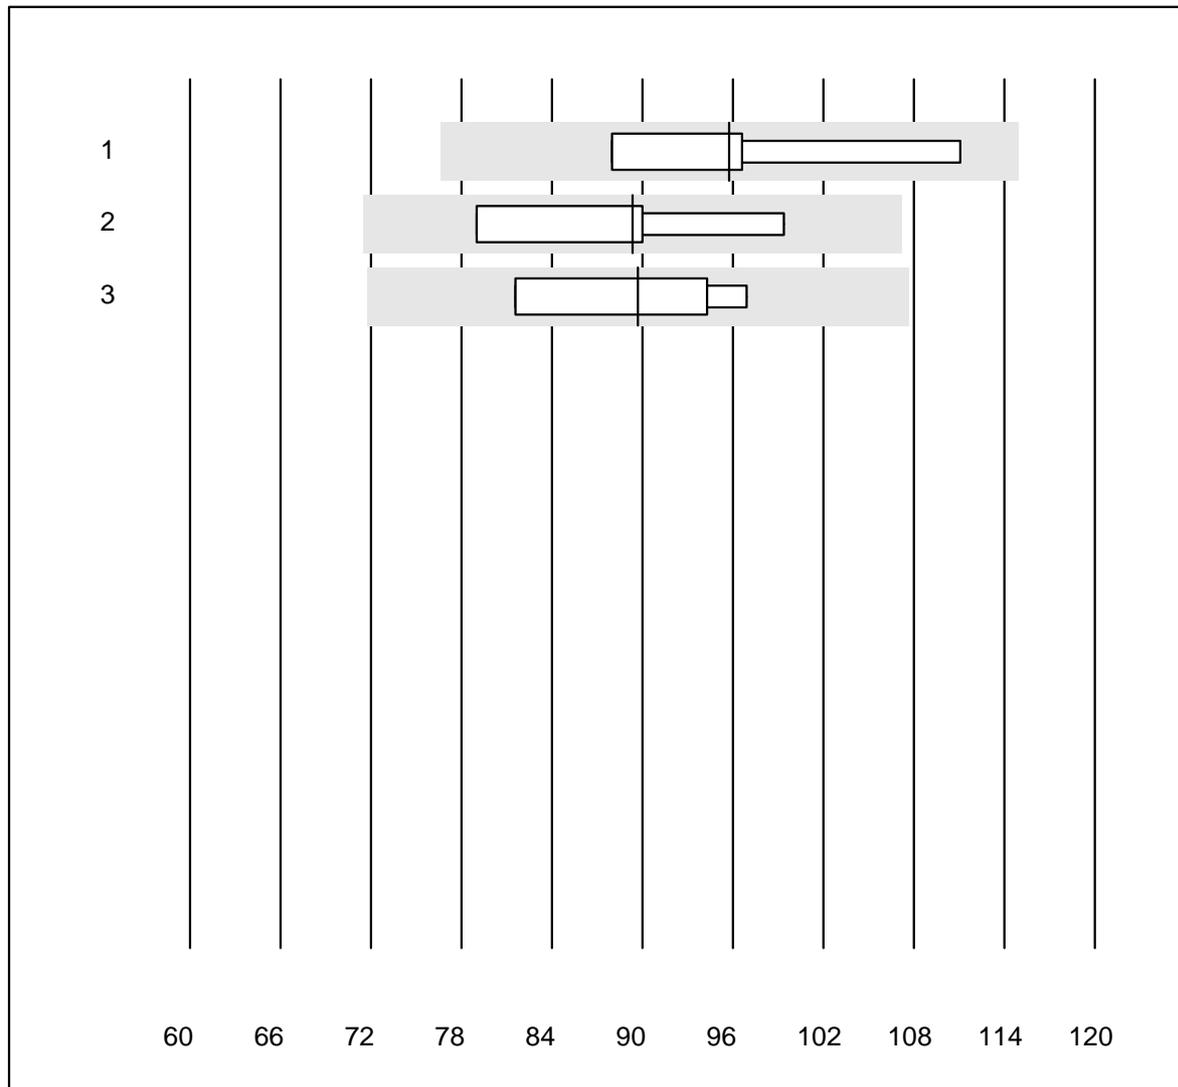


Tolérance MQ : 20 %

Anti-FXa (Rivaroxaban) (E/ml)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	95.75	10.6	a
2	Stago/STA	4	100.0	0.0	0.0	89.35	9.3	a
3	ACL	4	100.0	0.0	0.0	89.70	7.9	a

Anti-FXa (Apixaban)

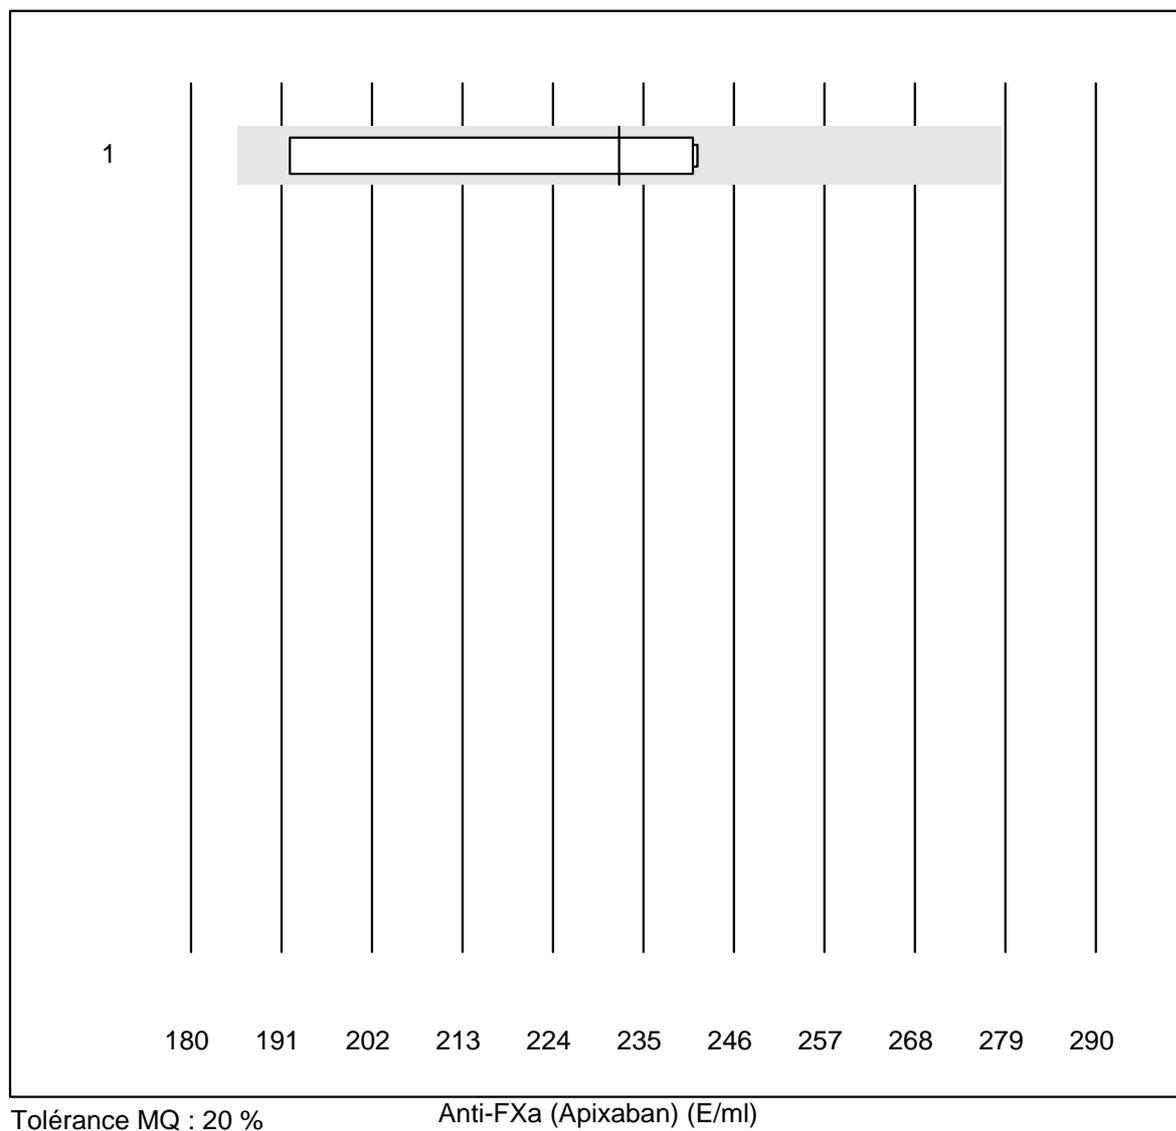

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	232.05	10.4	e*

Anti-FIIa (Dabigatran)

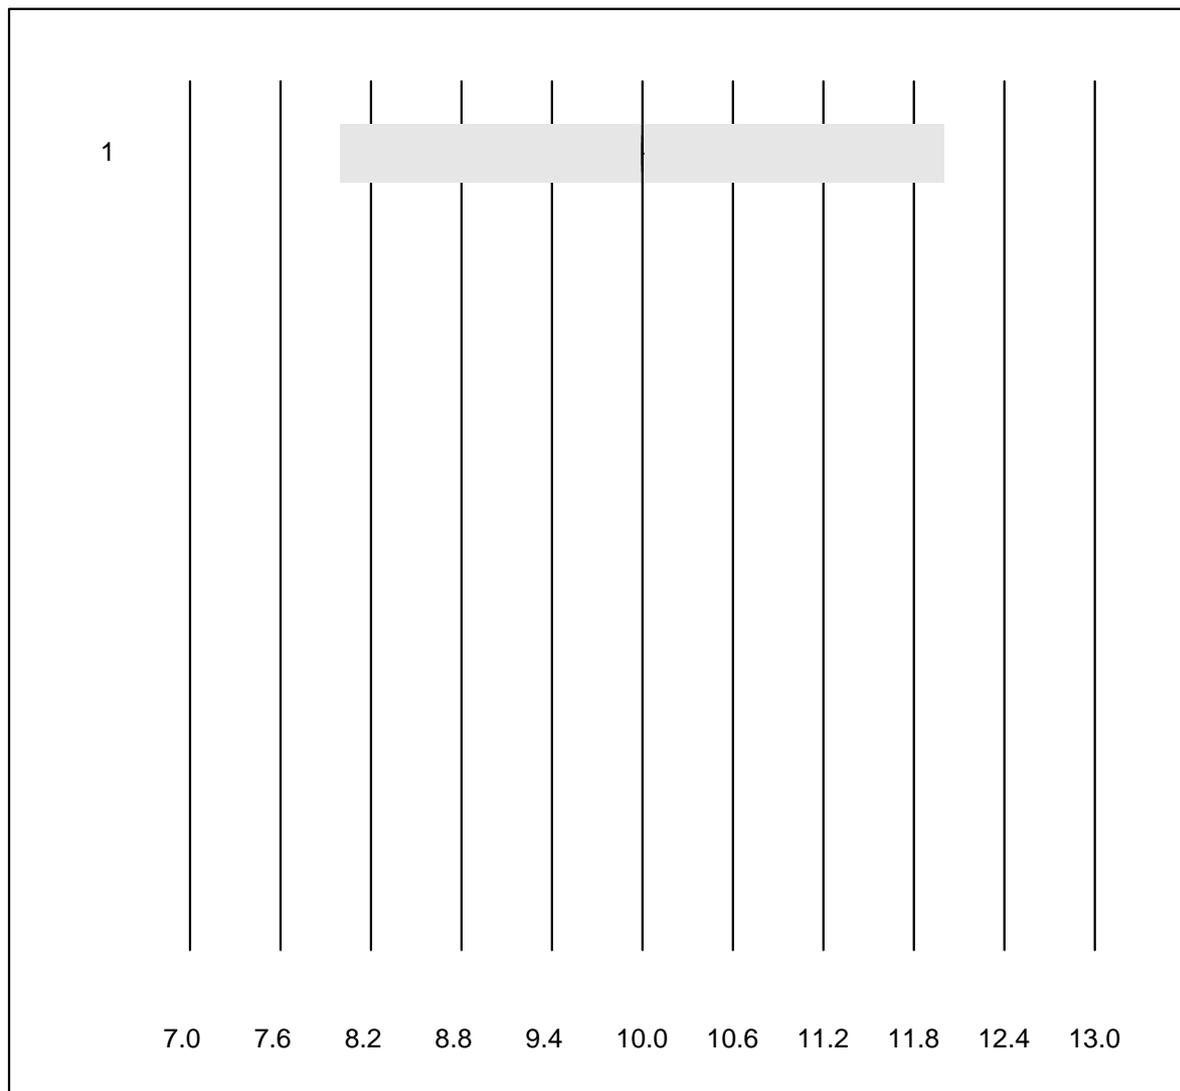


Tolérance MQ : 20 %

Anti-FIIa (Dabigatran) (E/ml)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	10.00	0.0	a

Hémoglobine

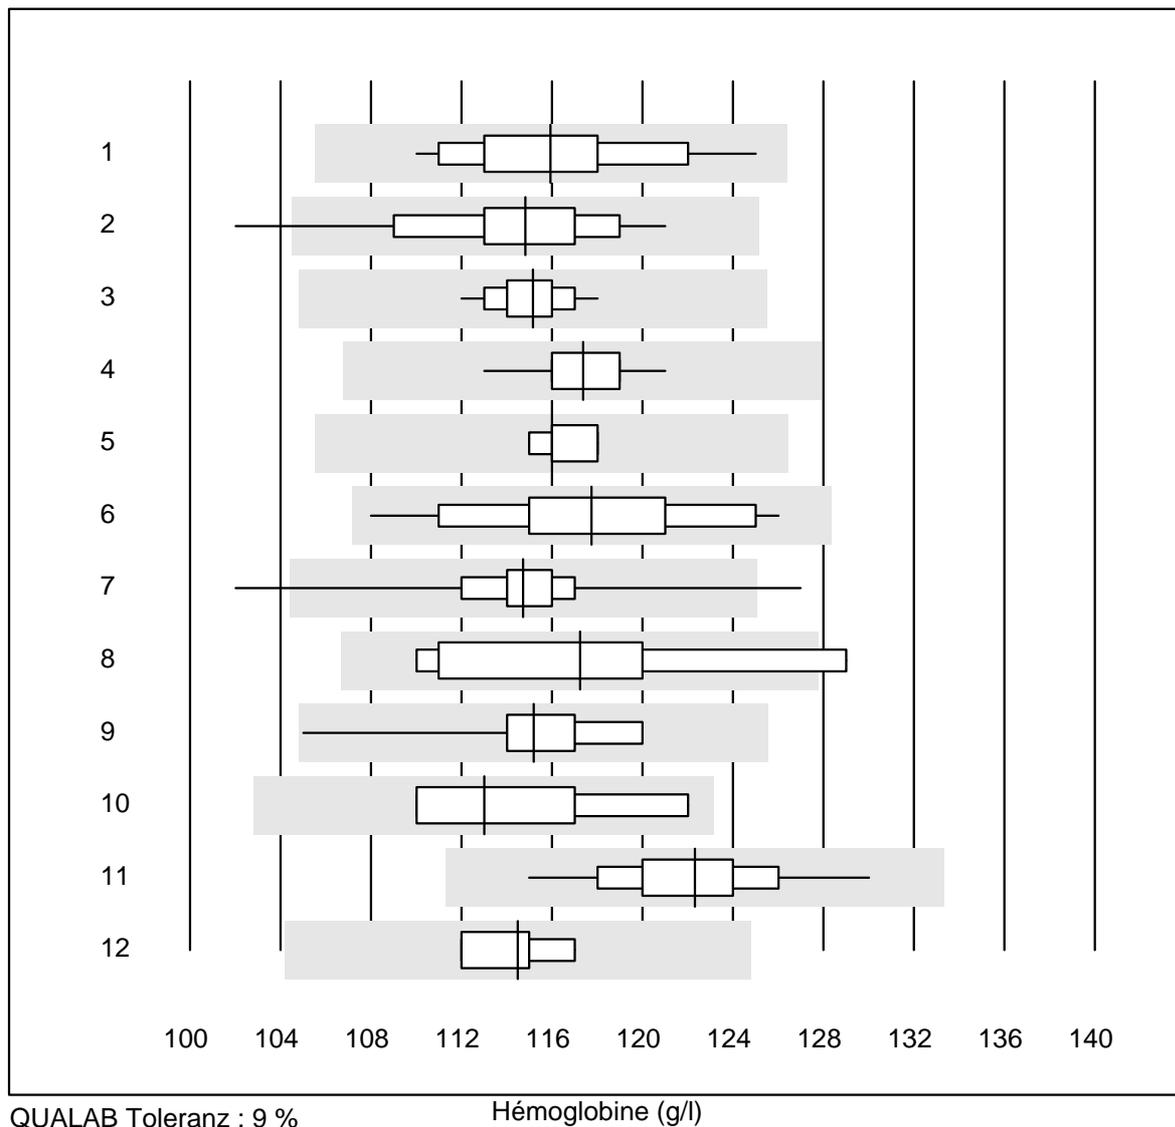


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Automate	25	96.0	0.0	4.0	115.9	3.5	e
2	Cyanmethémoglobine	31	93.6	3.2	3.2	114.8	3.4	e
3	Sysmex X	39	100.0	0.0	0.0	115.2	1.3	e
4	Advia 120	11	100.0	0.0	0.0	117.4	1.9	e
5	ABX Pentra	5	100.0	0.0	0.0	116.0	1.2	e
6	Reflotron	16	100.0	0.0	0.0	117.8	4.3	e
7	Hemocue	391	97.7	0.8	1.5	114.7	2.5	e
8	Dr. Lange	10	70.0	10.0	20.0	117.3	5.4	e*
9	Hemocontrol	11	100.0	0.0	0.0	115.2	3.5	e
10	Eurolyser	8	100.0	0.0	0.0	113.0	4.5	e*
11	DiaSpect	14	100.0	0.0	0.0	122.3	3.0	e
12	Sysmex	4	100.0	0.0	0.0	114.5	1.8	e

Hémoglobine

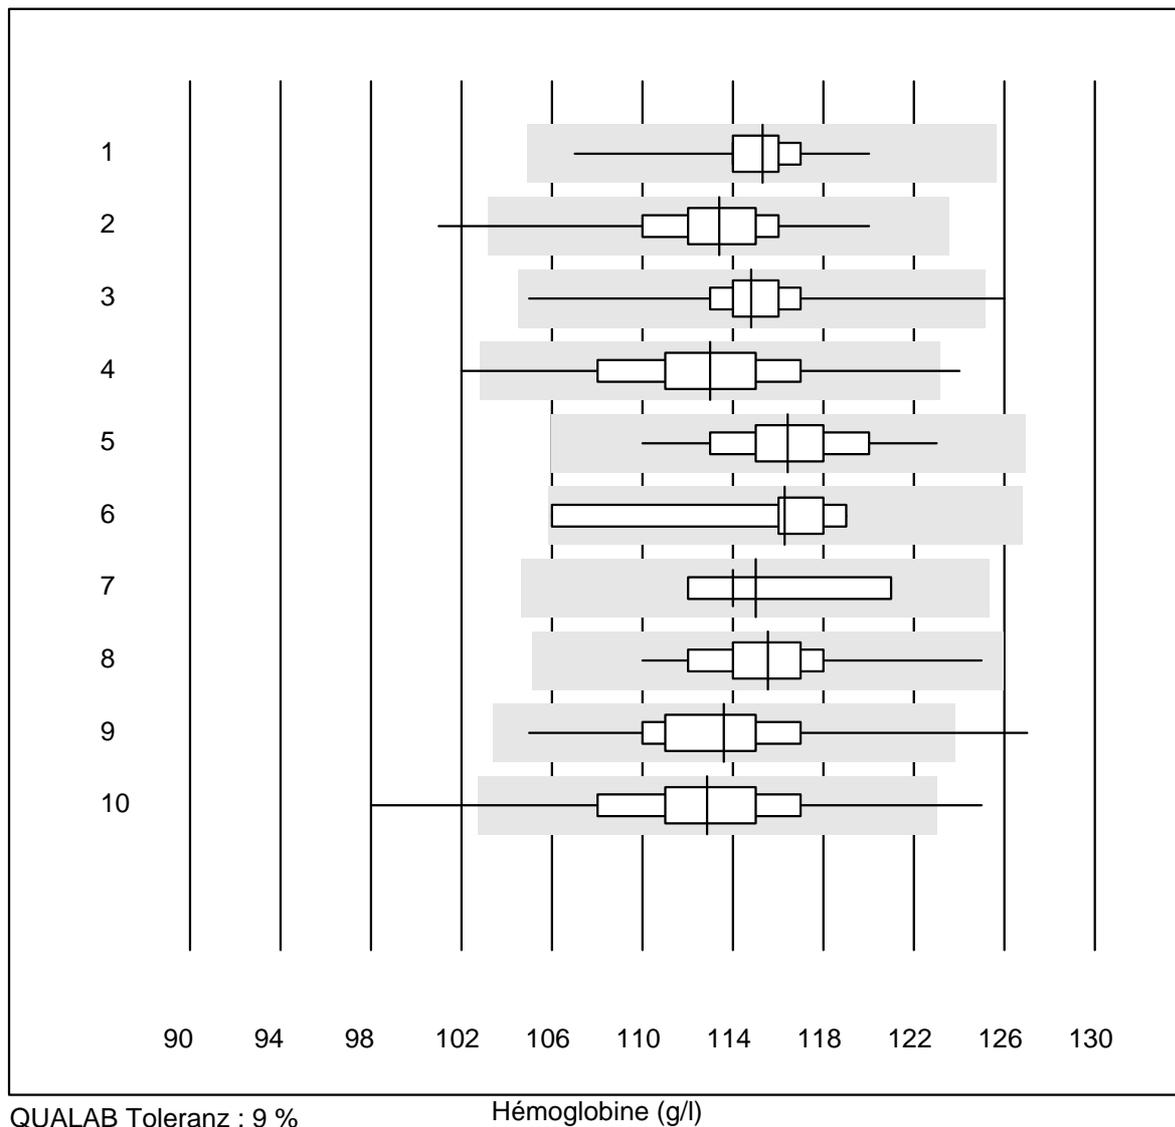

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex KX21	276	97.5	0.0	2.5	115.3	1.4	e
2	Sysmex PochH - 100i	196	99.0	0.5	0.5	113.4	2.2	e
3	Sysmex XP 300	503	99.0	0.2	0.8	114.8	1.4	e
4	Mythic	292	98.7	1.0	0.3	113.0	3.1	e
5	Swelab	47	97.9	0.0	2.1	116.4	2.4	e
6	Abacus Junior	10	100.0	0.0	0.0	116.3	3.2	e
7	Medonic	10	80.0	0.0	20.0	115.0	2.4	e
8	Celltac Alpha (Nihon	83	95.2	0.0	4.8	115.6	2.1	e
9	Samsung HC10	40	97.5	2.5	0.0	113.6	3.2	e
10	Micros 60	187	94.7	1.6	3.7	112.9	3.1	e

Hématocrite

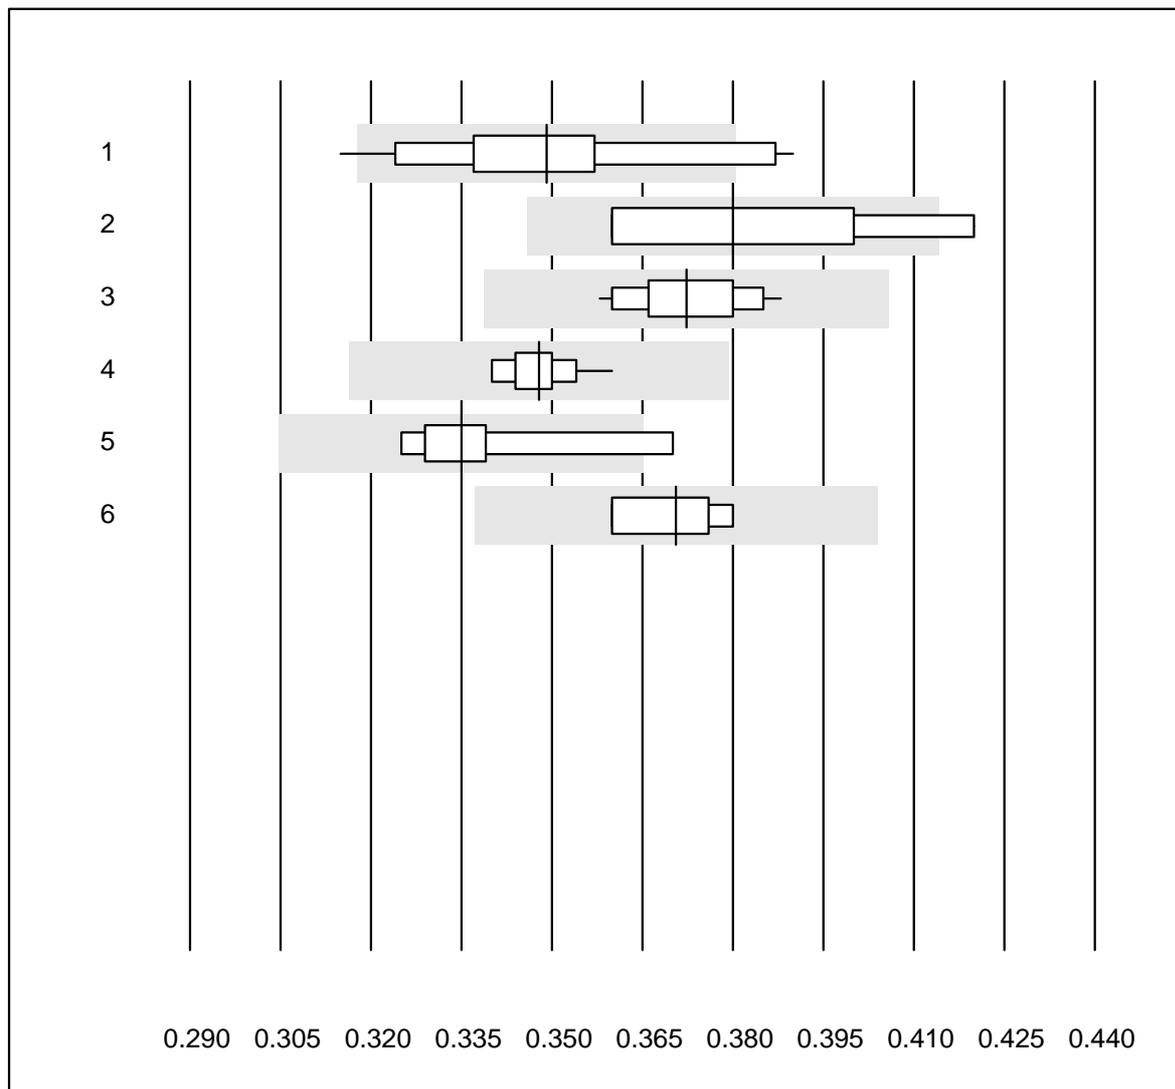


QUALAB Toleranz : 9 %

Hématocrite (l/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Automate	21	71.4	14.3	14.3	0.35	5.4	e*
2	Centrifuge	7	85.7	14.3	0.0	0.38	5.8	e*
3	Sysmex X	39	100.0	0.0	0.0	0.37	2.3	e
4	Advia 120	11	100.0	0.0	0.0	0.35	1.7	e
5	ABX Pentra	5	80.0	20.0	0.0	0.34	5.2	e*
6	Sysmex	4	100.0	0.0	0.0	0.37	2.5	e*

Hématocrite

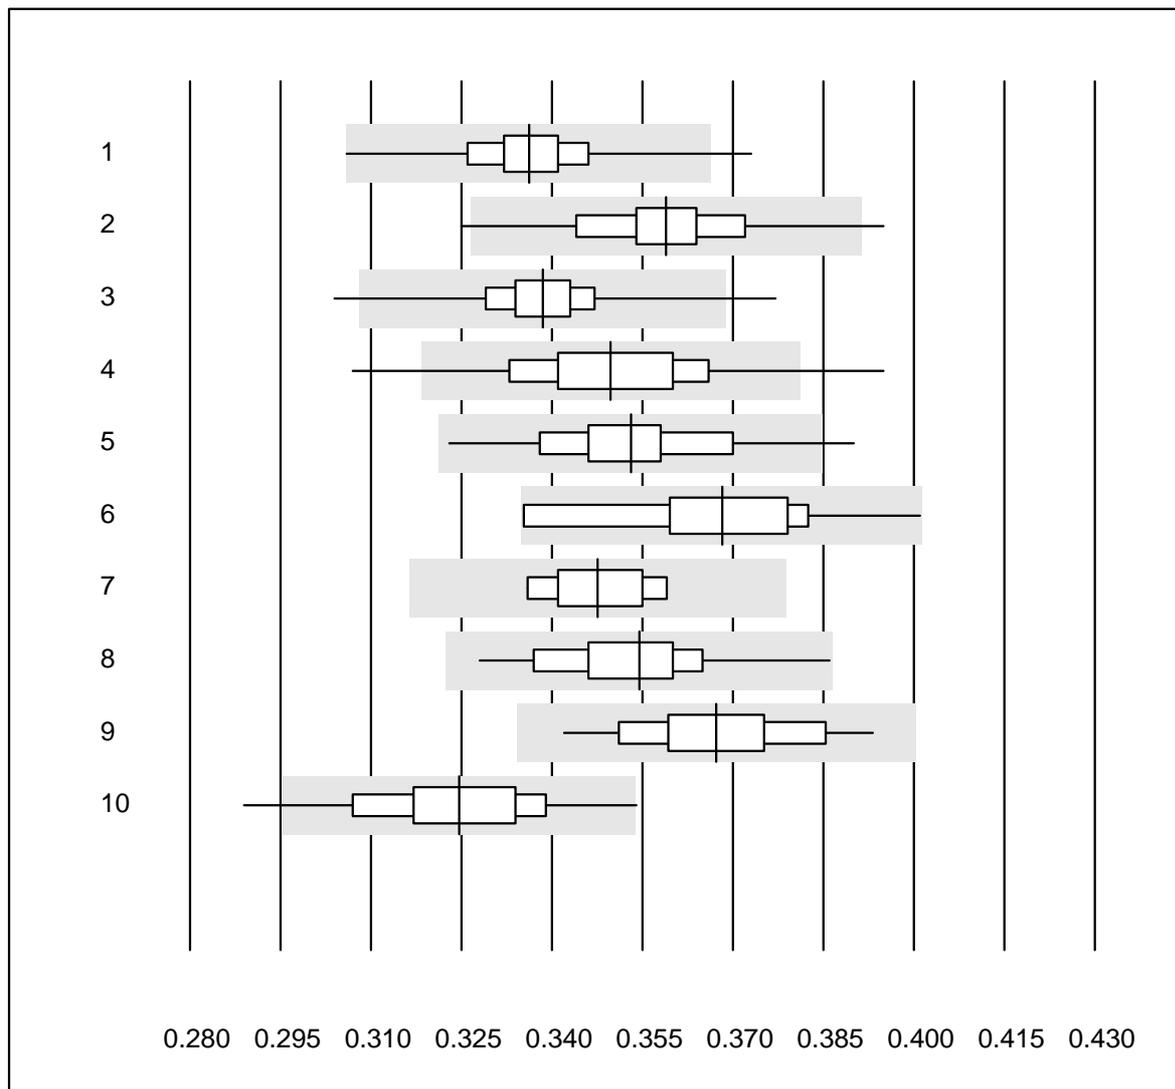


QUALAB Toleranz : 9 %

Hématocrite (l/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex KX21	274	96.0	2.2	1.8	0.34	2.7	e
2	Sysmex PochH - 100i	197	98.5	1.0	0.5	0.36	2.9	e
3	Sysmex XP 300	505	98.0	1.0	1.0	0.34	2.3	e
4	Mythic	293	96.9	2.4	0.7	0.35	3.9	e
5	Swelab	47	93.6	4.3	2.1	0.35	3.7	e
6	Abacus Junior	10	100.0	0.0	0.0	0.37	5.3	e*
7	Medonic	10	80.0	0.0	20.0	0.35	2.5	e
8	Celltac Alpha (Nihon	84	95.2	0.0	4.8	0.35	3.0	e
9	Samsung HC10	41	100.0	0.0	0.0	0.37	3.6	e
10	Micros 60	187	90.9	3.2	5.9	0.32	4.0	e

Erythrocytes

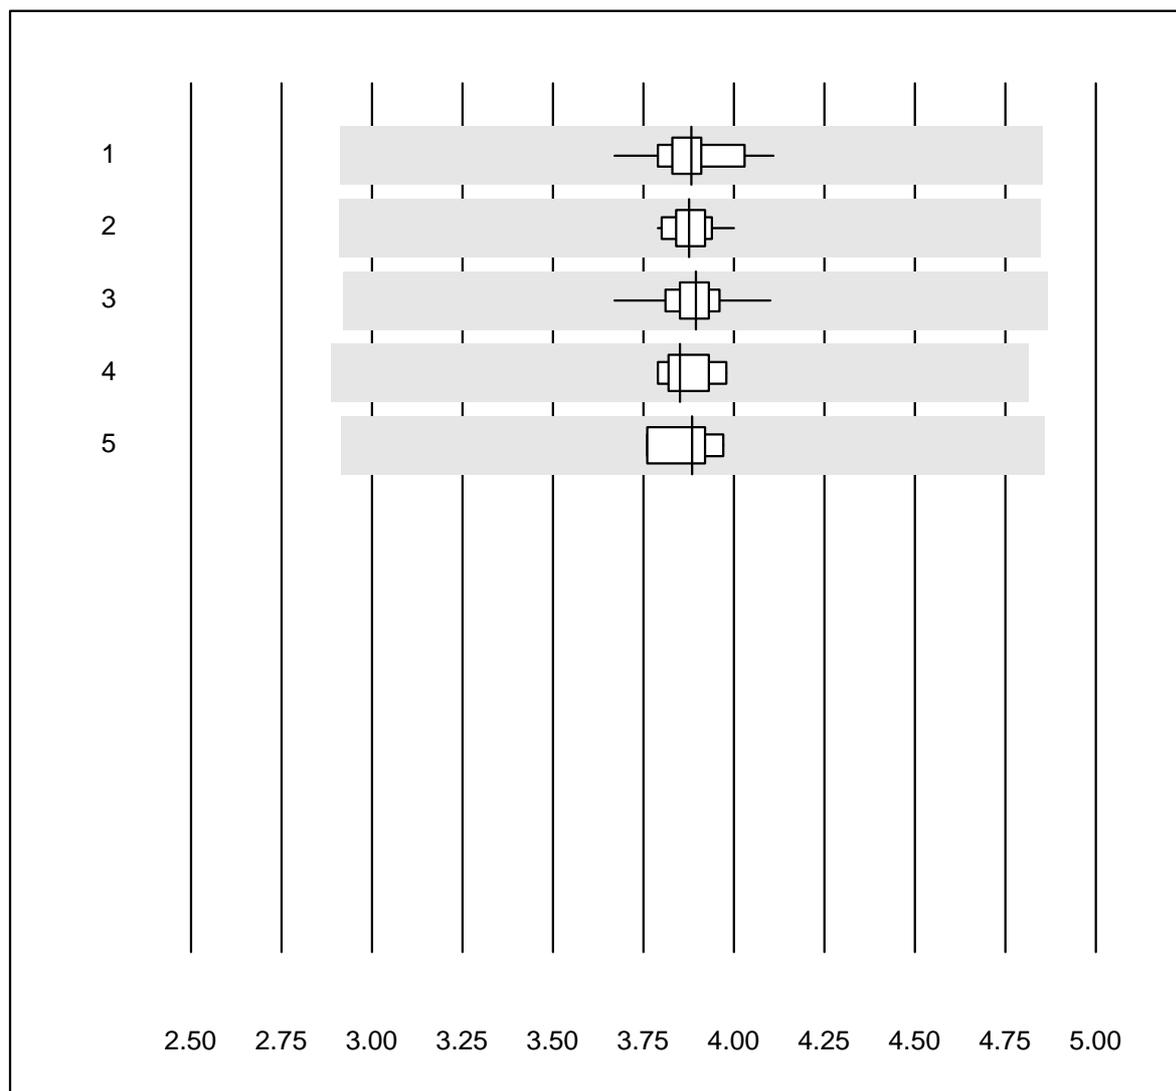


QUALAB Toleranz : 25 %

Erythrocytes (T/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Automate	19	100.0	0.0	0.0	3.88	2.6	e
2 Sysmex X	39	100.0	0.0	0.0	3.88	1.3	e
3 Advia 120	11	100.0	0.0	0.0	3.89	2.7	e
4 ABX Pentra	5	100.0	0.0	0.0	3.85	2.0	e
5 Sysmex	4	100.0	0.0	0.0	3.89	2.4	e

Erythrocytes

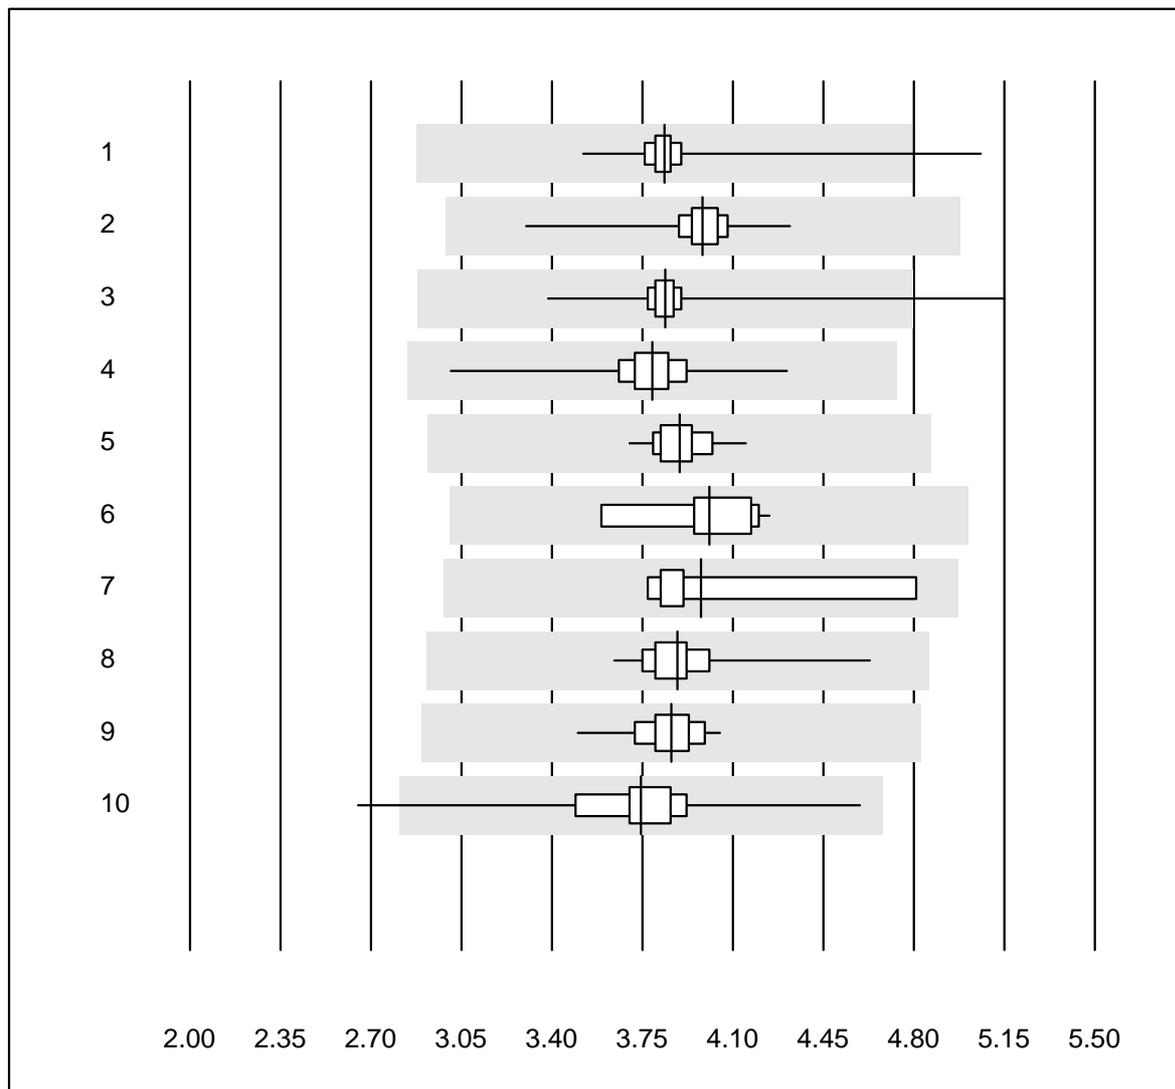


QUALAB Toleranz : 25 %

Erythrocytes (T/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex KX21	274	98.1	0.4	1.5	3.83	2.6	e
2	Sysmex PochH - 100i	197	100.0	0.0	0.0	3.98	2.5	e
3	Sysmex XP 300	505	99.6	0.2	0.2	3.84	2.4	e
4	Mythic	293	99.7	0.0	0.3	3.79	3.3	e
5	Swelab	47	97.9	0.0	2.1	3.89	2.3	e
6	Abacus Junior	10	100.0	0.0	0.0	4.01	5.3	e
7	Medonic	10	90.0	0.0	10.0	3.98	8.1	e
8	Celltac Alpha (Nihon	84	97.6	0.0	2.4	3.89	3.9	e
9	Samsung HC10	40	100.0	0.0	0.0	3.86	3.0	e
10	Micros 60	187	97.8	1.1	1.1	3.74	5.9	e

Leucocytes

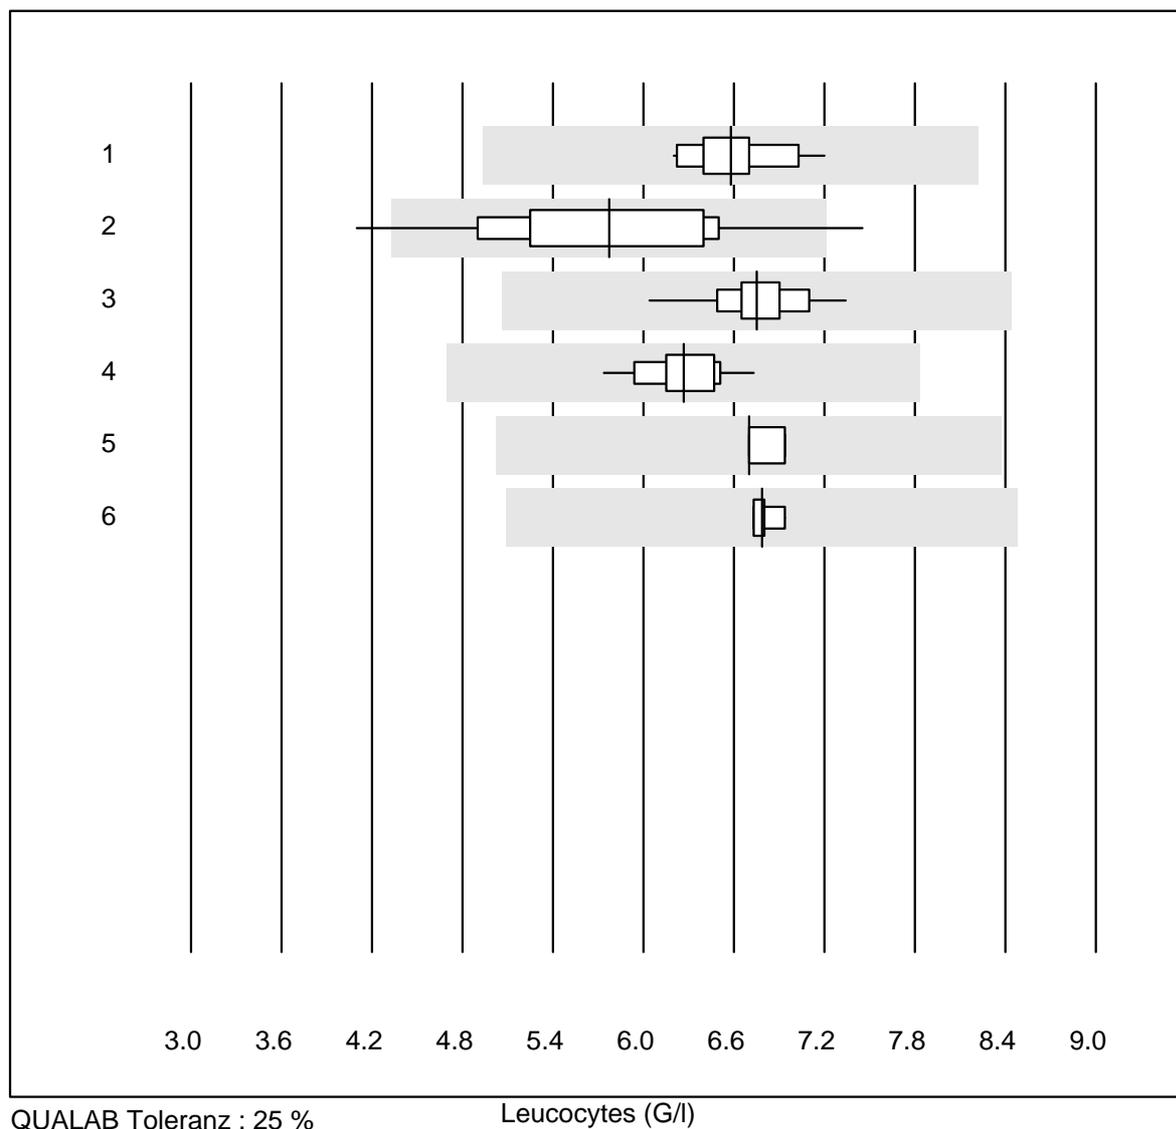


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Automate	17	100.0	0.0	0.0	6.58	4.4	e
2	Microscopie	24	83.3	12.5	4.2	5.77	13.5	e
3	Sysmex X	39	100.0	0.0	0.0	6.75	3.6	e
4	Advia 120 (Perox)	11	100.0	0.0	0.0	6.27	4.4	e
5	ABX Pentra	5	60.0	0.0	40.0	6.70	1.8	e
6	Sysmex	4	100.0	0.0	0.0	6.79	1.3	e

Leucocytes

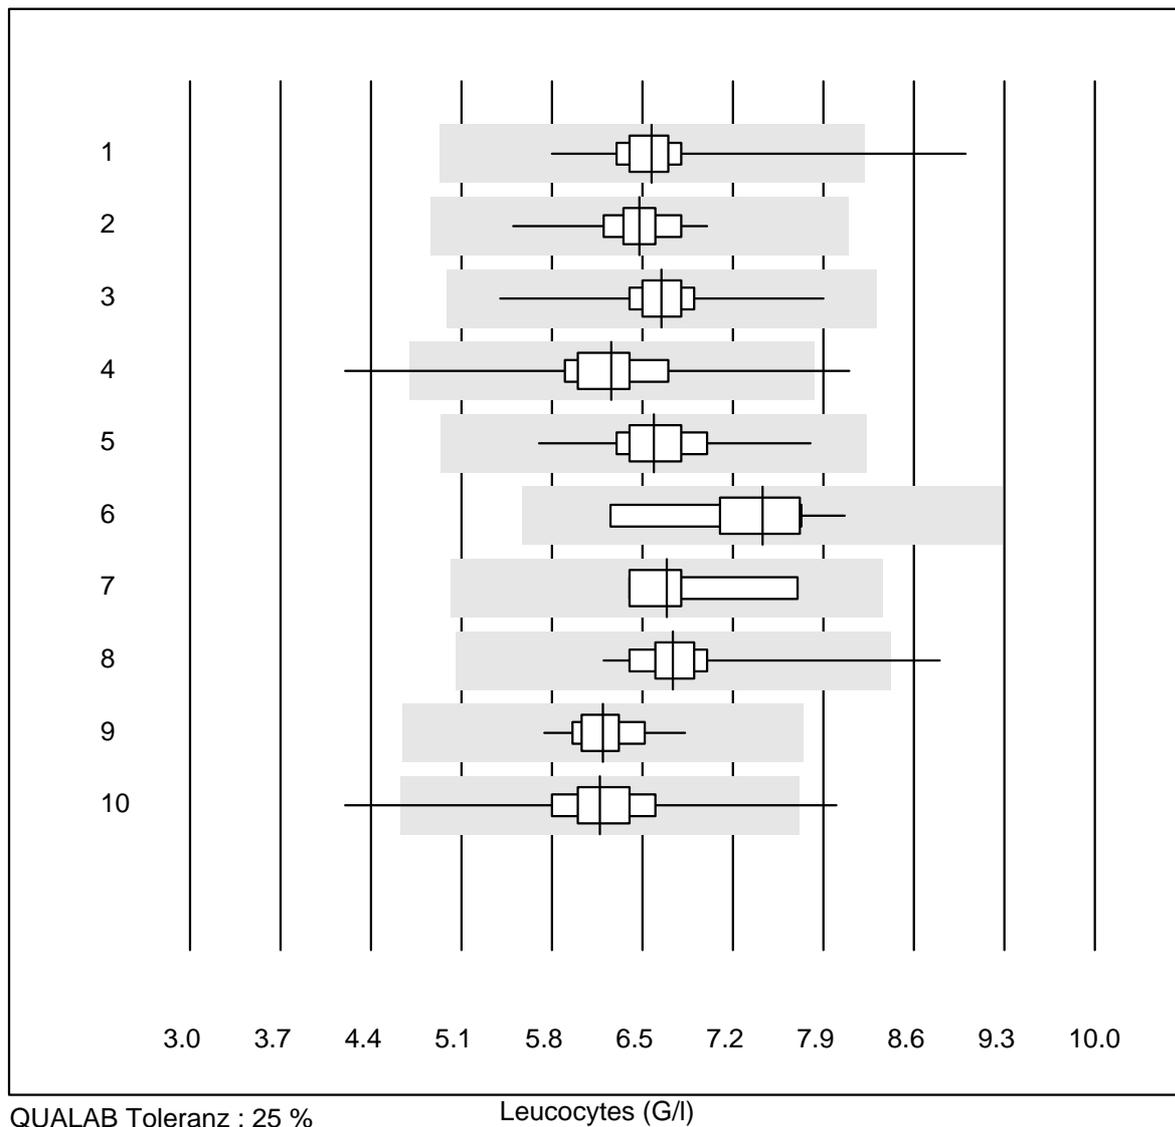


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex KX21	274	98.9	0.4	0.7	6.57	4.4	e
2	Sysmex PochH - 100i	196	100.0	0.0	0.0	6.48	3.4	e
3	Sysmex XP 300	507	100.0	0.0	0.0	6.65	2.9	e
4	Mythic	292	97.6	0.7	1.7	6.26	5.8	e
5	Swelab	47	97.9	0.0	2.1	6.59	5.2	e
6	Abacus Junior	10	100.0	0.0	0.0	7.43	7.0	e
7	Medonic	10	90.0	0.0	10.0	6.69	6.3	e
8	Celltac Alpha (Nihon	84	97.6	1.2	1.2	6.73	4.8	e
9	Samsung HC10	41	97.6	0.0	2.4	6.19	3.6	e
10	Micros 60	187	98.4	1.1	0.5	6.17	6.4	e

Thrombocytes

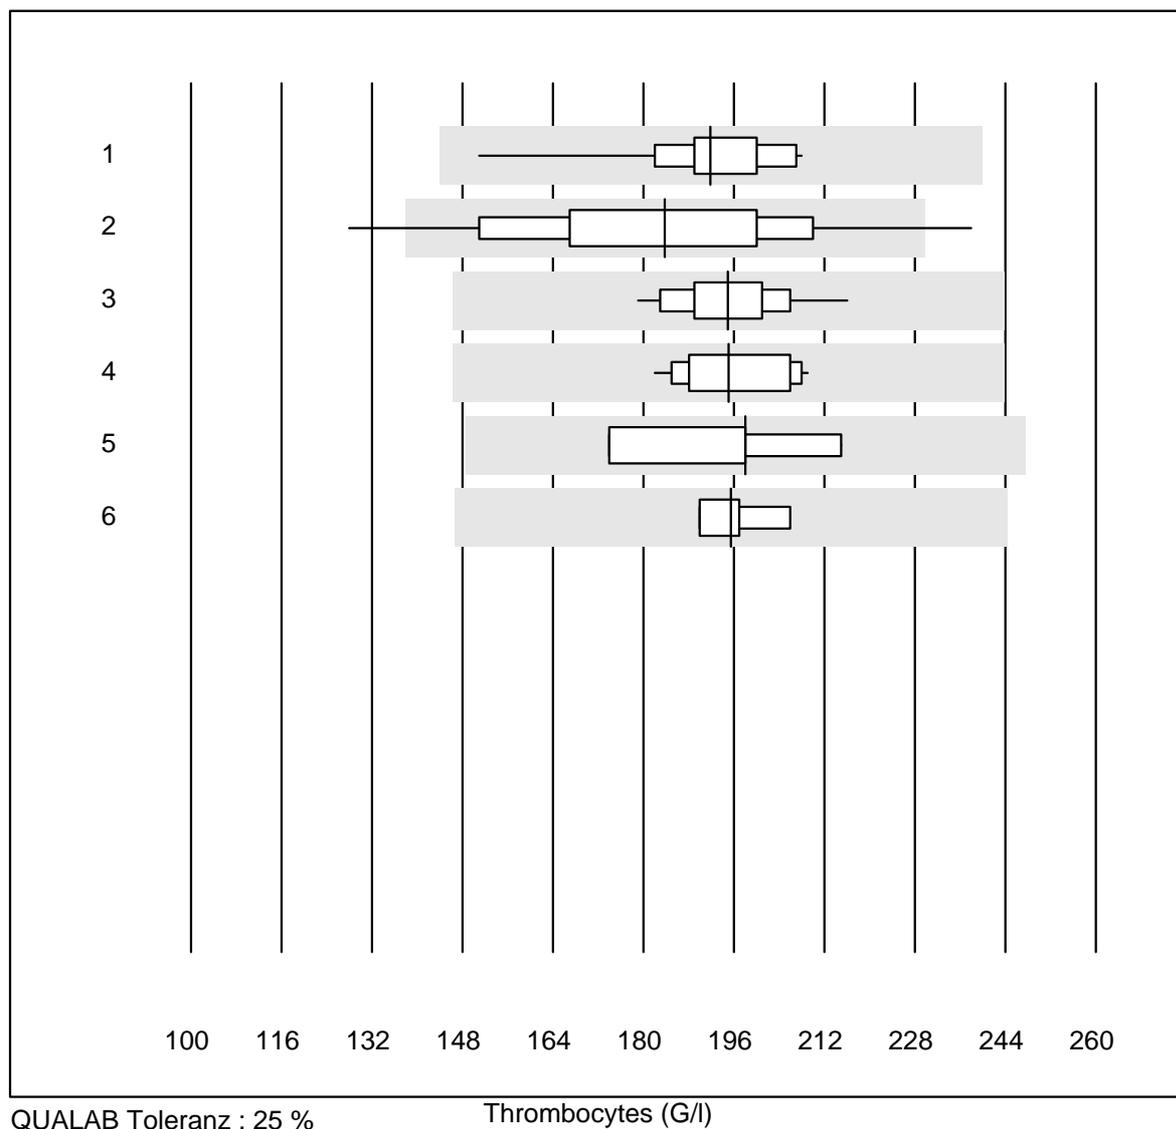

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Automate	16	100.0	0.0	0.0	191.9	7.0	e
2	Microscopie	16	81.2	12.5	6.3	183.8	15.0	e*
3	Sysmex X	39	100.0	0.0	0.0	194.9	4.7	e
4	Advia 120	11	100.0	0.0	0.0	195.0	4.7	e
5	ABX Pentra	5	80.0	0.0	20.0	198.0	8.6	e*
6	Sysmex	4	100.0	0.0	0.0	195.5	3.5	e

Thrombocytes

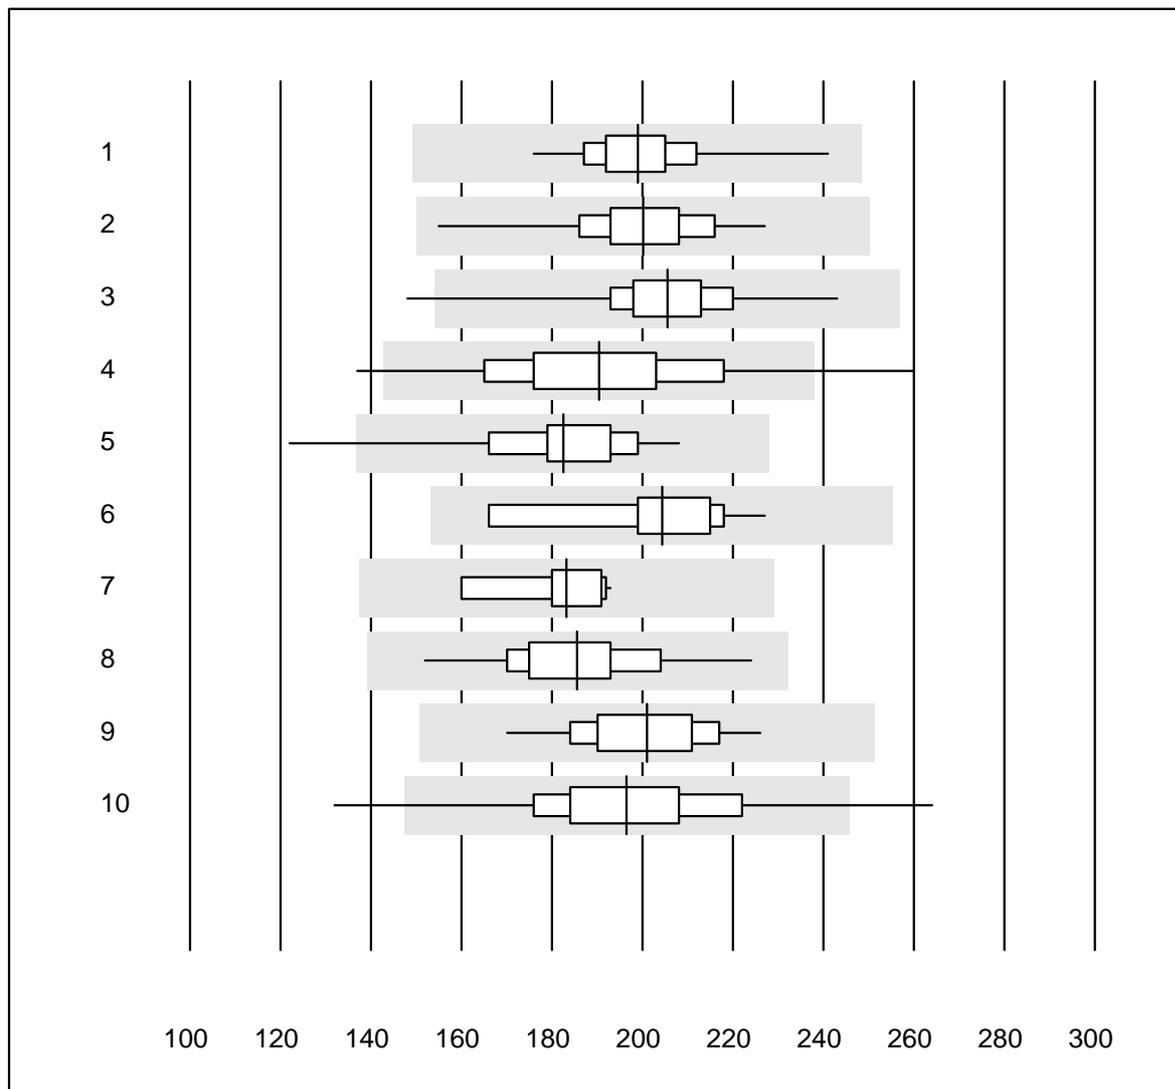


QUALAB Toleranz : 25 %

Thrombocytes (G/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex KX21	274	99.6	0.0	0.4	198.9	5.2	e
2	Sysmex PochH - 100i	197	99.0	0.0	1.0	200.2	5.8	e
3	Sysmex XP 300	506	99.6	0.2	0.2	205.5	5.6	e
4	Mythic	293	96.0	2.0	2.0	190.4	10.9	e
5	Swelab	47	93.6	4.3	2.1	182.5	9.0	e
6	Abacus Junior	10	100.0	0.0	0.0	204.4	8.4	e
7	Medonic	10	100.0	0.0	0.0	183.2	5.5	e
8	Celltac Alpha (Nihon	84	98.8	0.0	1.2	185.6	7.4	e
9	Samsung HC10	41	97.6	0.0	2.4	200.9	6.5	e
10	Micros 60	187	94.7	3.2	2.1	196.6	9.9	e

Hémoglobine H2

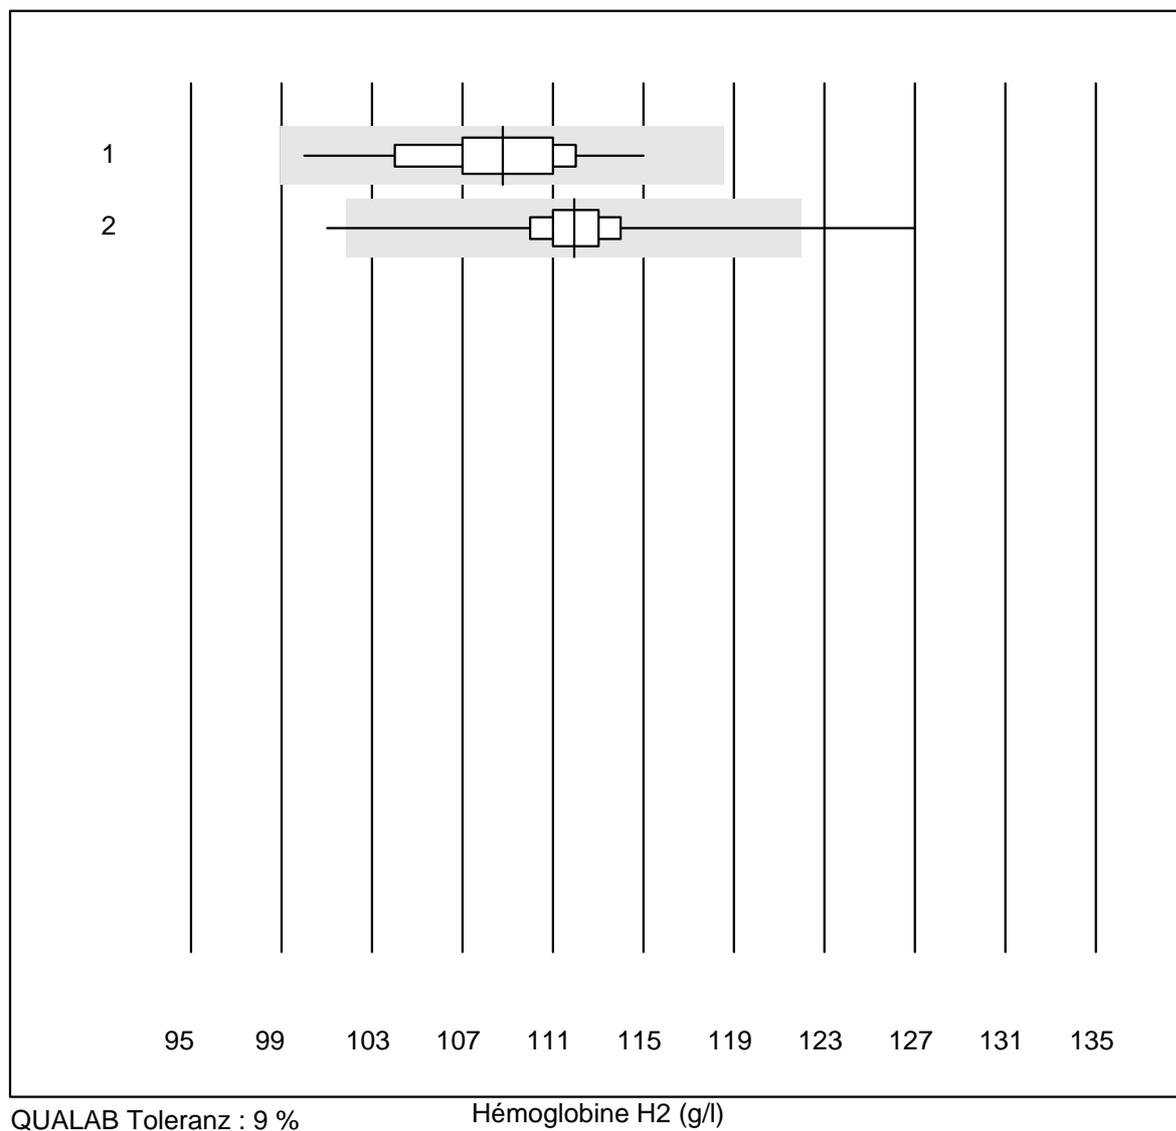

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Abx Micros	177	98.9	0.0	1.1	108.8	3.0	e
2	Microsemi	717	98.5	0.4	1.1	111.9	1.9	e

Hématocrite H2

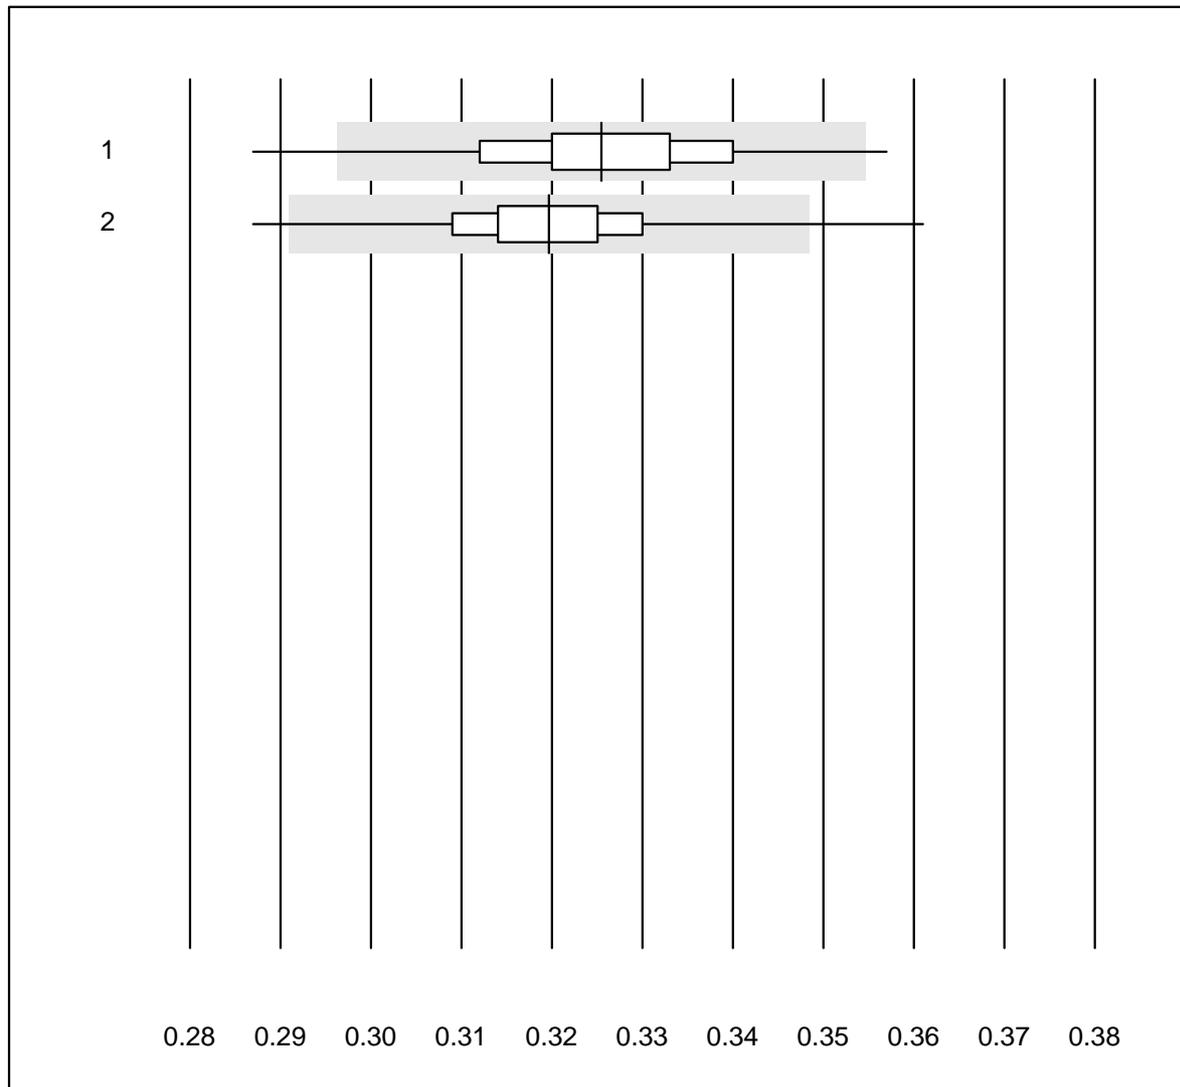


QUALAB Toleranz : 9 %

Hématocrite H2 (l/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Abx Micros	177	97.1	2.3	0.6	0.33	3.5	e
2 Microsemi	717	97.9	0.7	1.4	0.32	2.7	e

Leucocytes H2

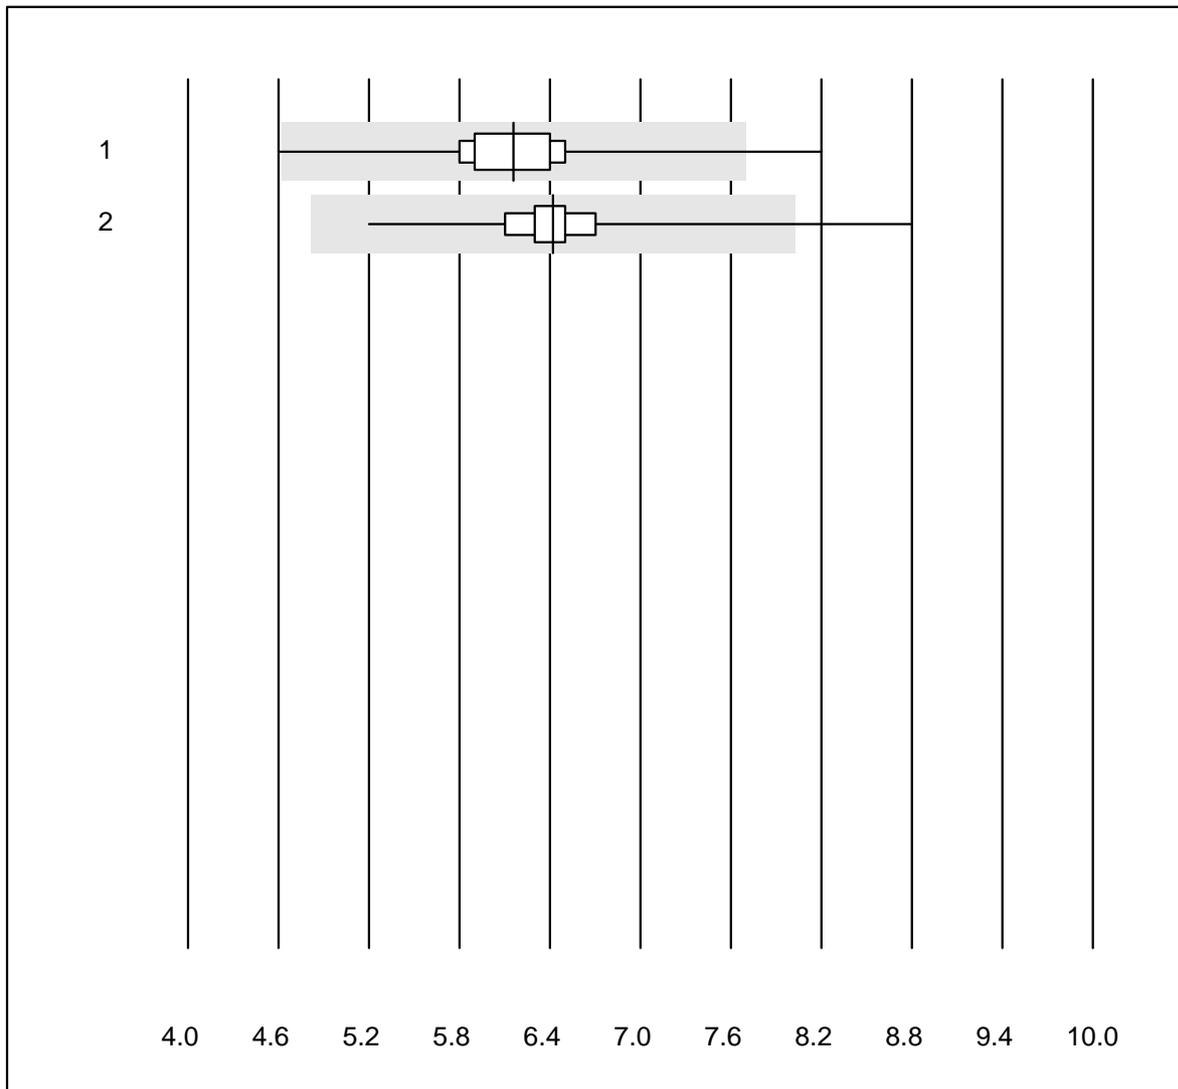


QUALAB Toleranz : 25 %

Leucocytes H2 (G/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Abx Micros	177	98.3	1.1	0.6	6.16	5.7	e
2	Microsemi	717	99.3	0.6	0.1	6.42	4.6	e

Thrombocytes H2

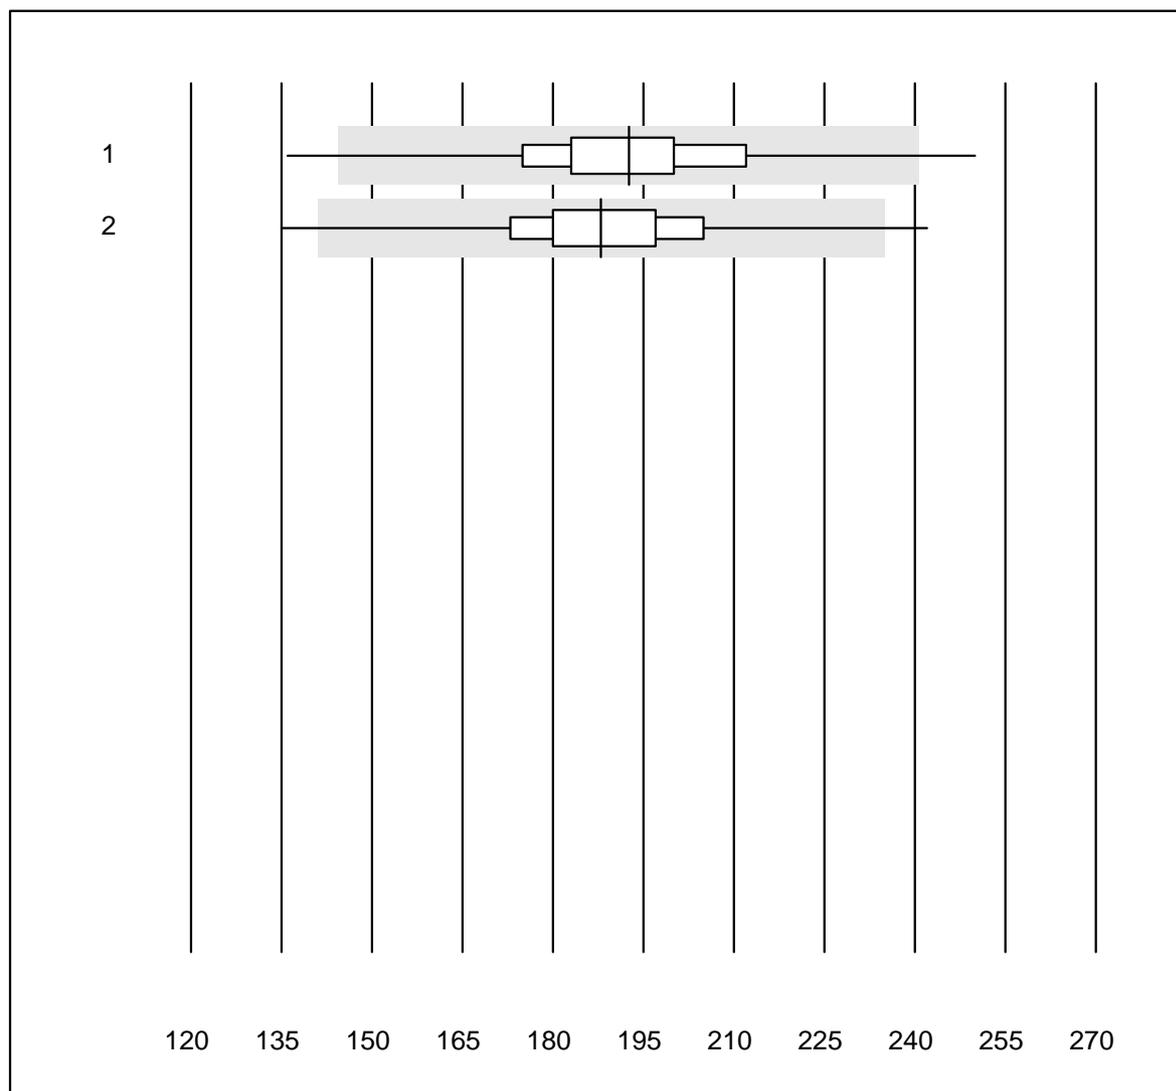


QUALAB Toleranz : 25 %

Thrombocytes H2 (G/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Abx Micros	177	96.6	2.3	1.1	192.6	8.2	e
2	Microsemi	717	98.3	1.0	0.7	188.0	7.6	e

Erythrocytes H2

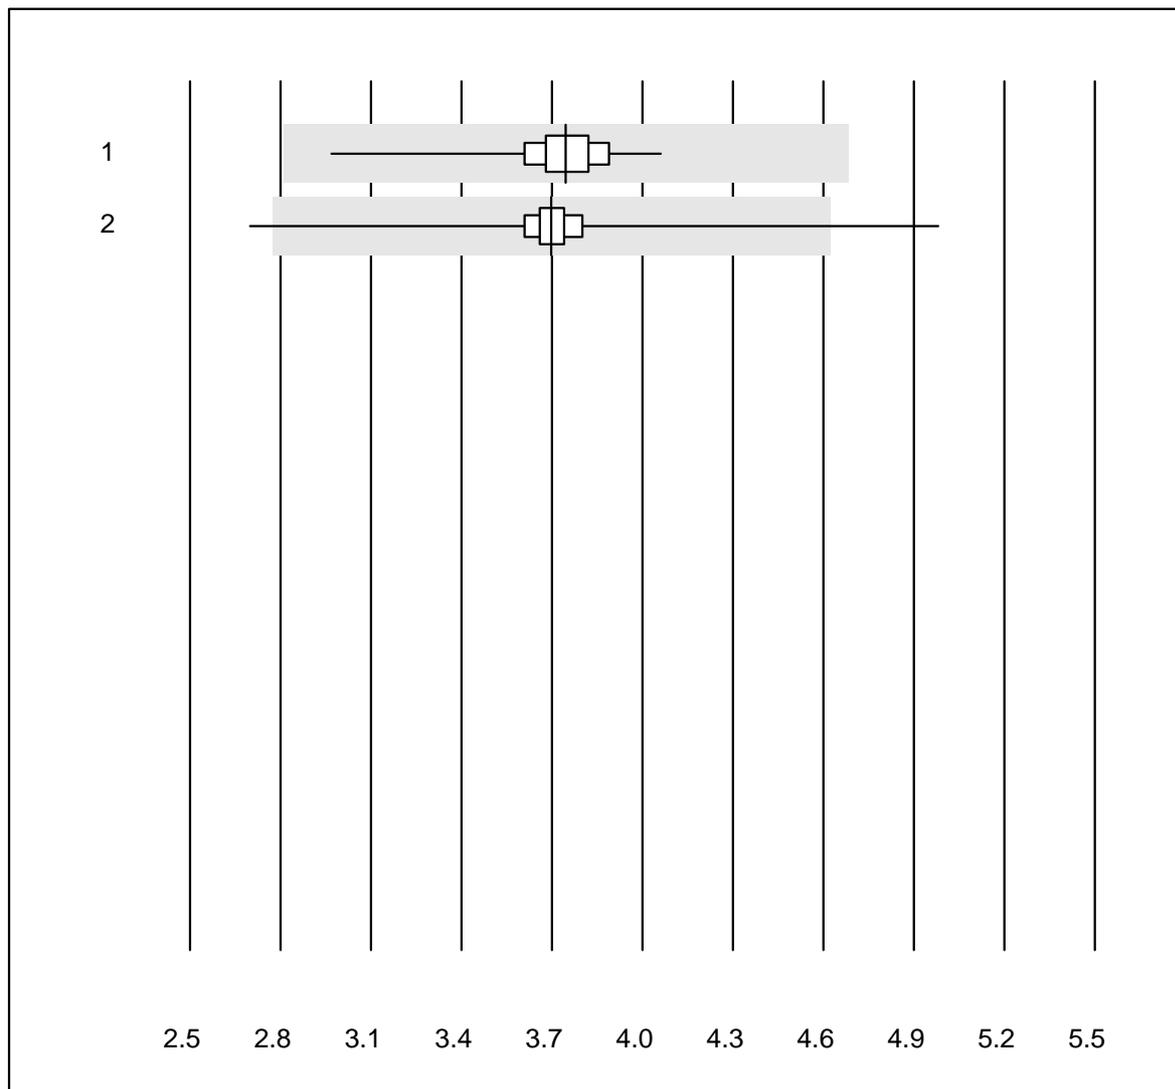


QUALAB Toleranz : 25 %

Erythrocytes H2 (T/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Abx Micros	177	99.4	0.0	0.6	3.75	3.4	e
2	Microsemi	717	98.8	0.4	0.8	3.70	3.0	e

CRP H2

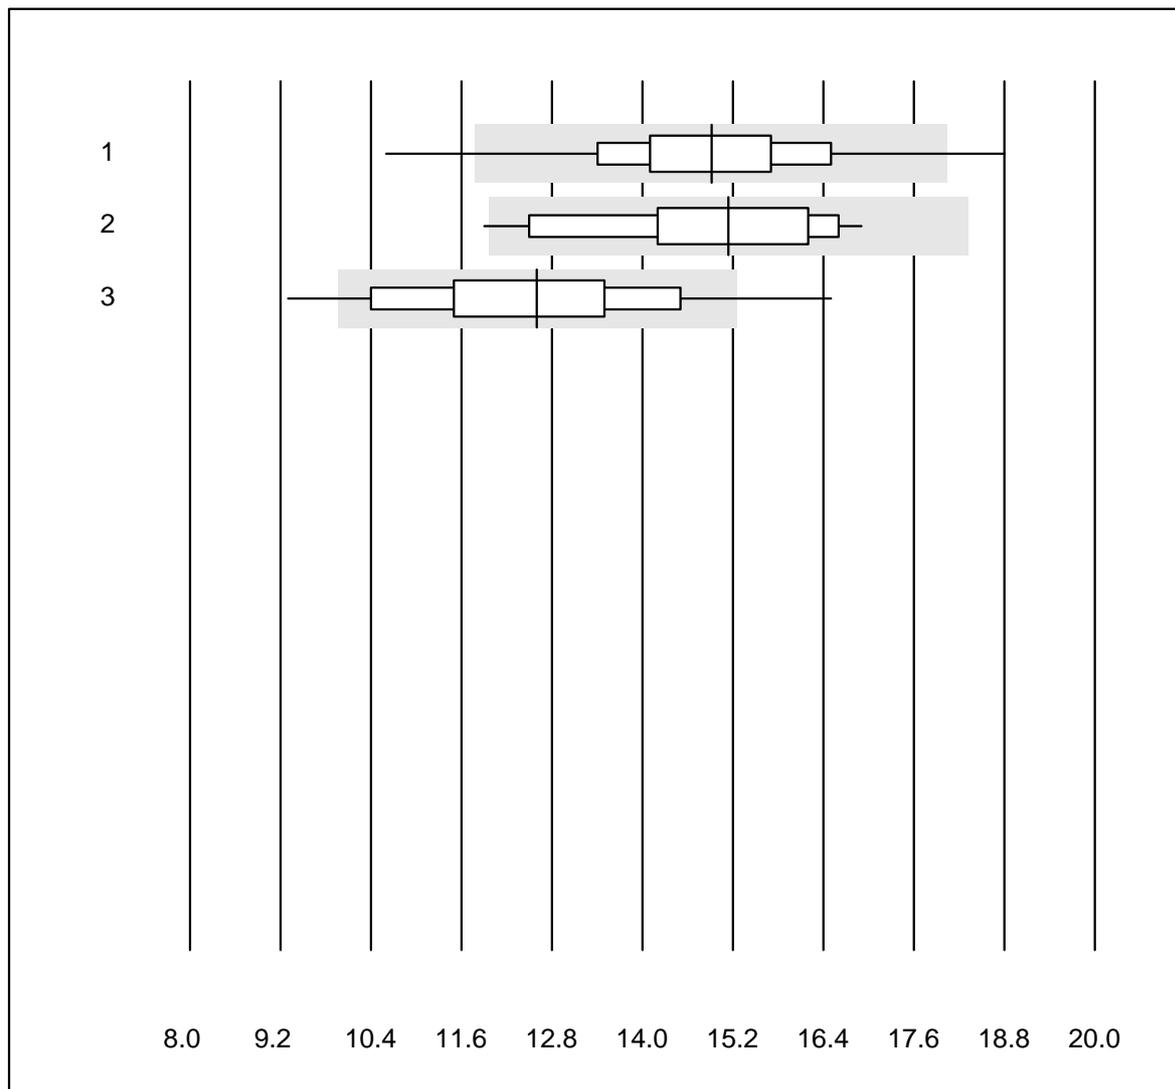


QUALAB Toleranz : 21 %

CRP H2 (mg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Microsemi	705	95.2	1.3	3.5	14.9	8.3	e
2	Abx Micros	18	83.3	5.6	11.1	15.1	9.4	e
3	ABX Micros CRP200	152	88.8	9.2	2.0	12.6	12.4	e

Hémoglobine BG

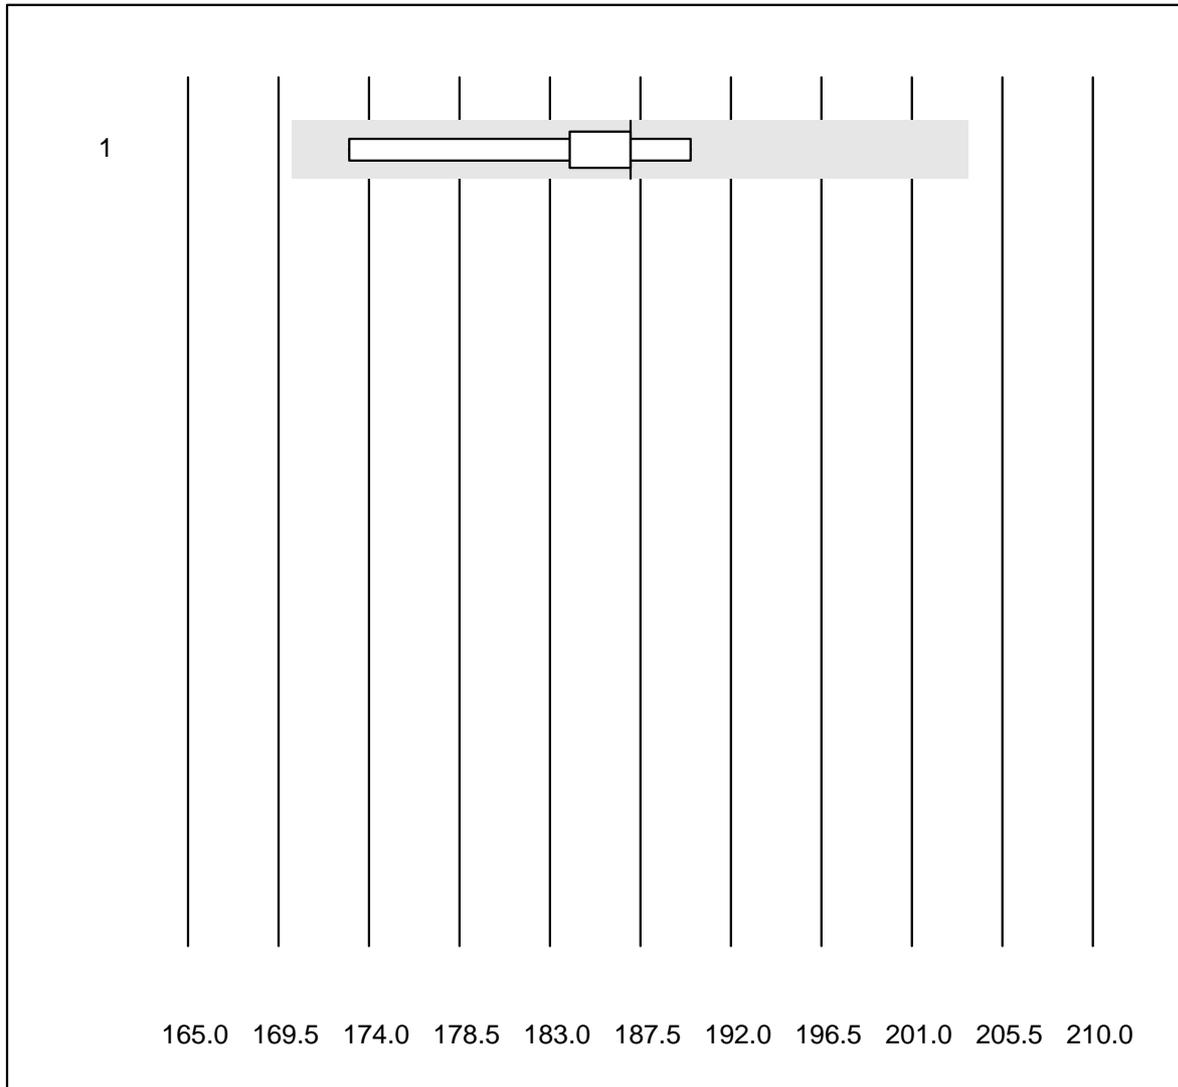


QUALAB Toleranz : 9 %

Hémoglobine BG (g/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 iStat	5	100.0	0.0	0.0	187.0	3.6	e*

Hématocrite

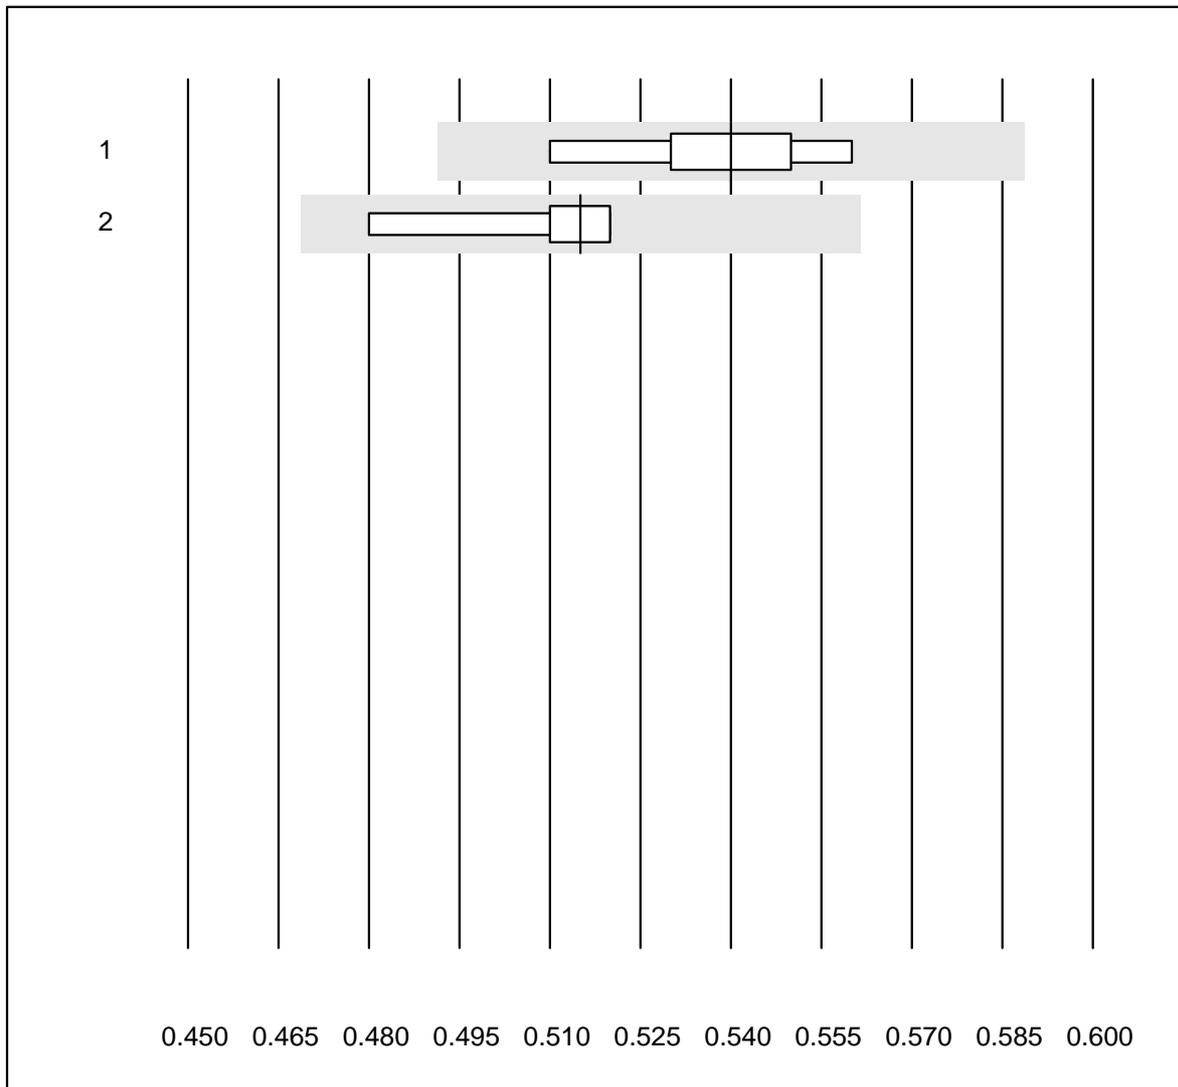


QUALAB Toleranz : 9 %

Hématocrite (l/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 iStat	7	100.0	0.0	0.0	0.54	3.1	e*
2 EPOC	6	83.3	0.0	16.7	0.52	3.4	e*

Hémoglobine

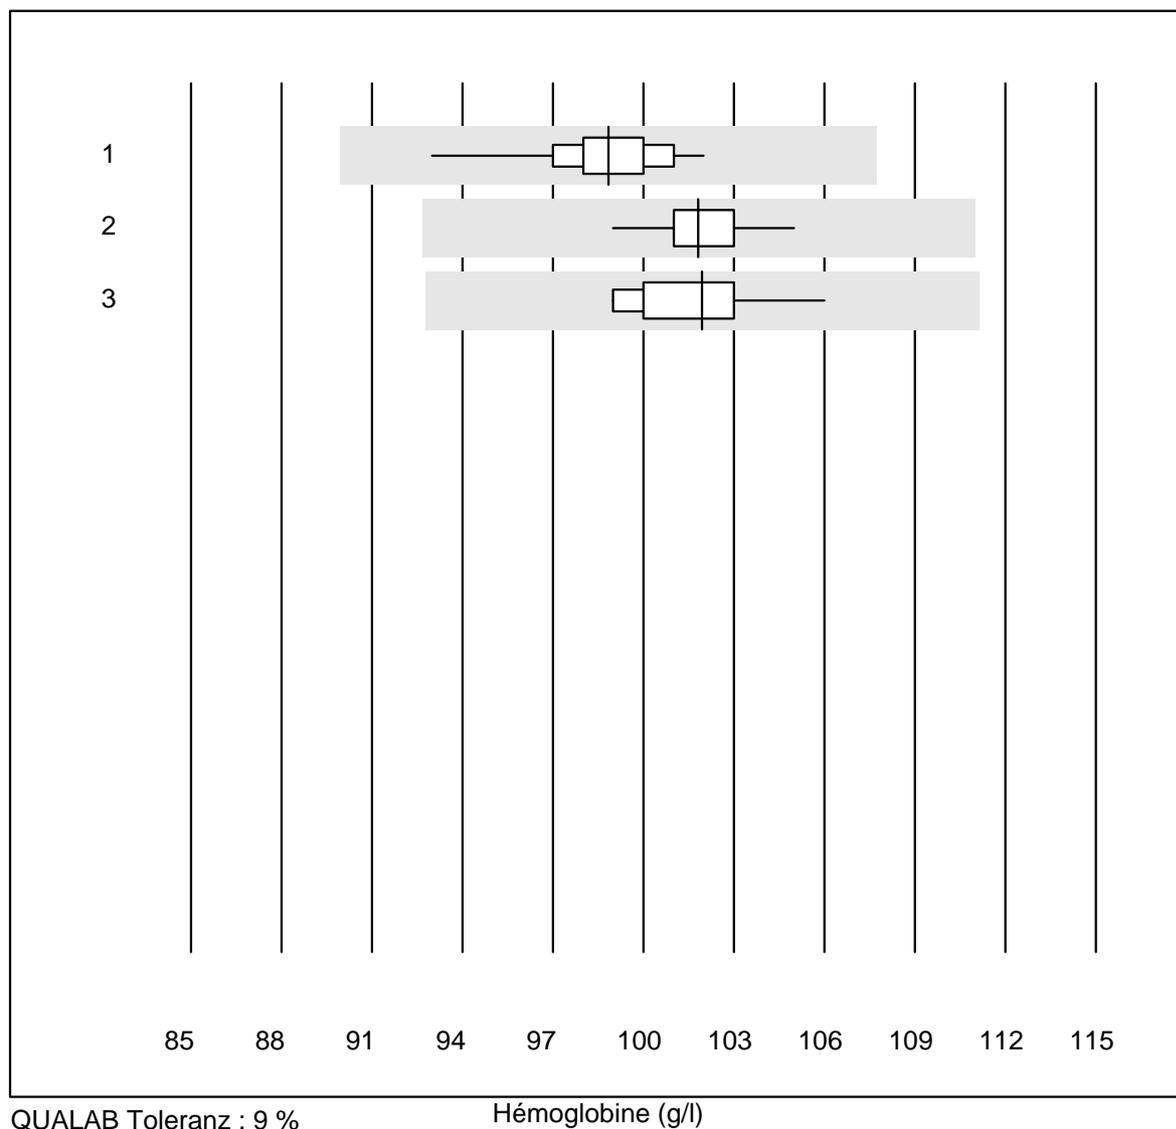


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex	56	100.0	0.0	0.0	98.8	1.5	e
2	Advia	11	100.0	0.0	0.0	101.8	1.5	e
3	ABX Pentra	13	100.0	0.0	0.0	101.9	2.0	e

Hématocrite

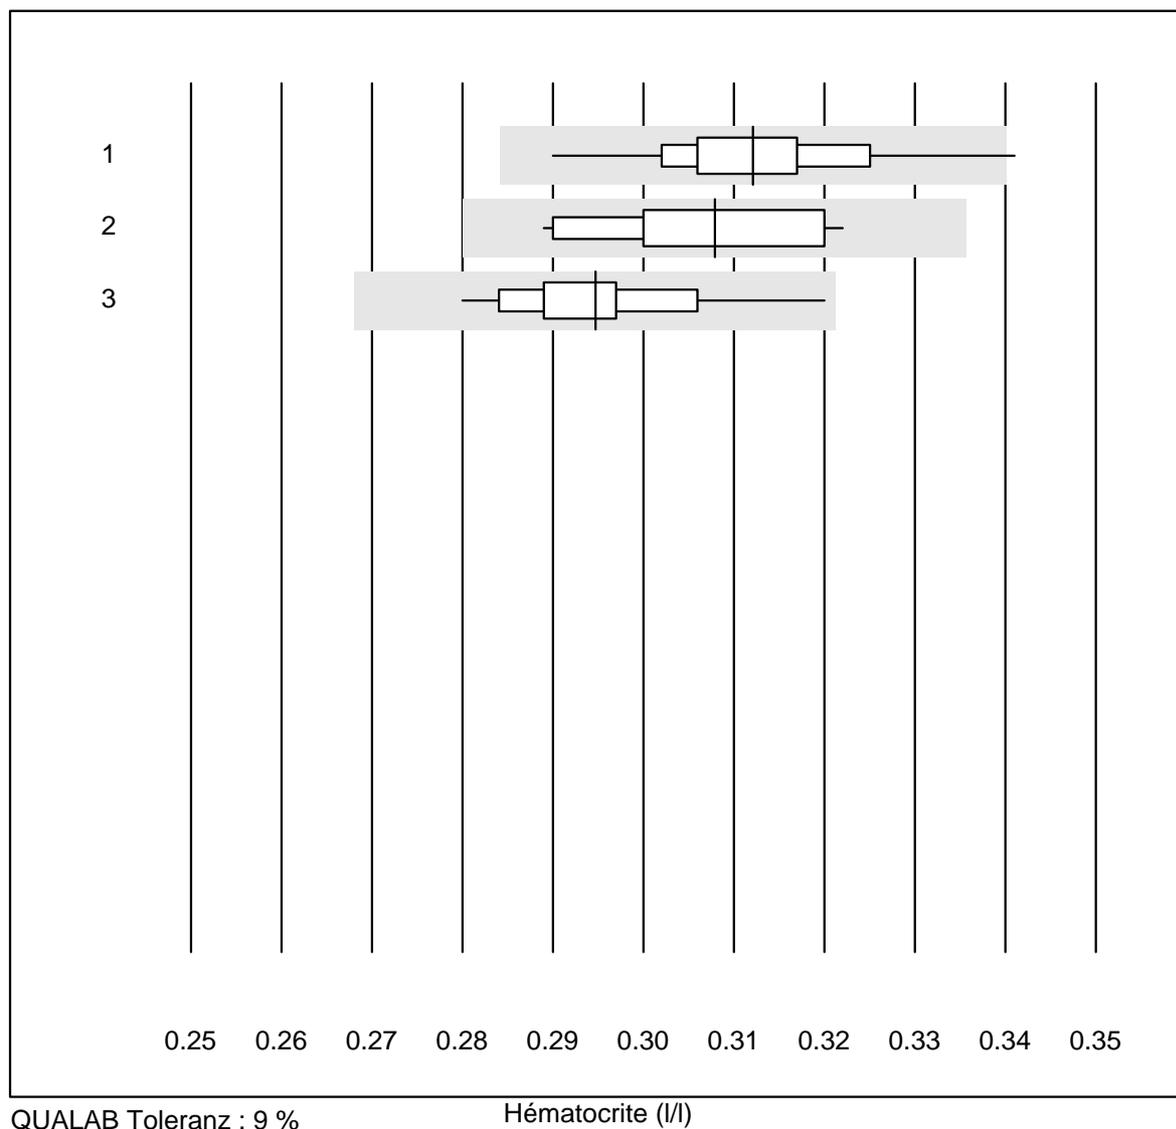

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	57	96.4	1.8	1.8	0.31	3.1	e
2 Advia	11	100.0	0.0	0.0	0.31	3.8	e*
3 ABX Pentra	13	100.0	0.0	0.0	0.29	3.4	e

Erythrocytes

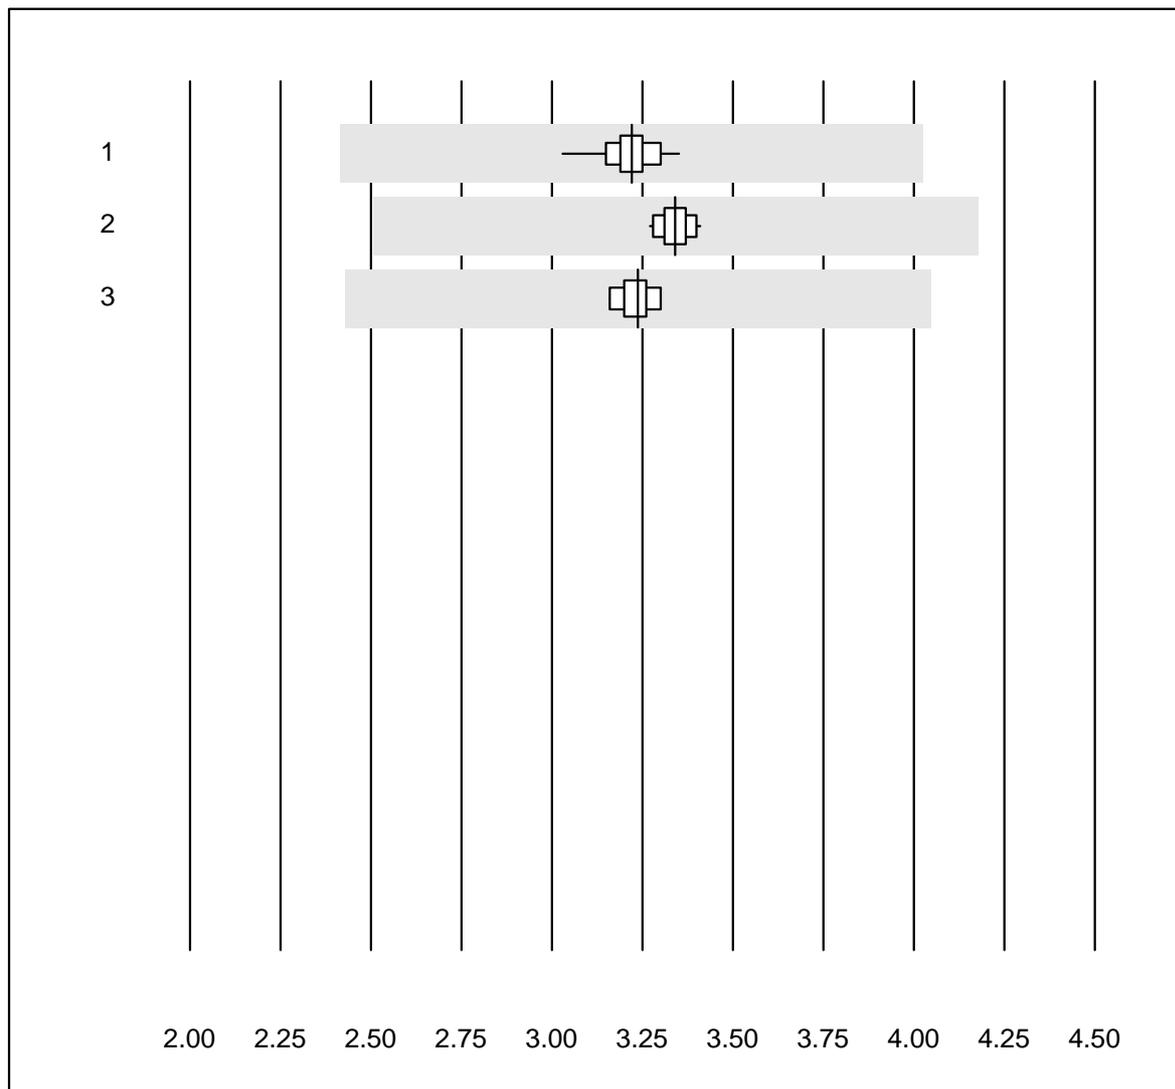


QUALAB Toleranz : 25 %

Erythrocytes (T/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex	56	100.0	0.0	0.0	3.22	1.8	e
2	Advia	11	100.0	0.0	0.0	3.34	1.3	e
3	ABX Pentra	13	100.0	0.0	0.0	3.24	1.4	e

Leucocytes

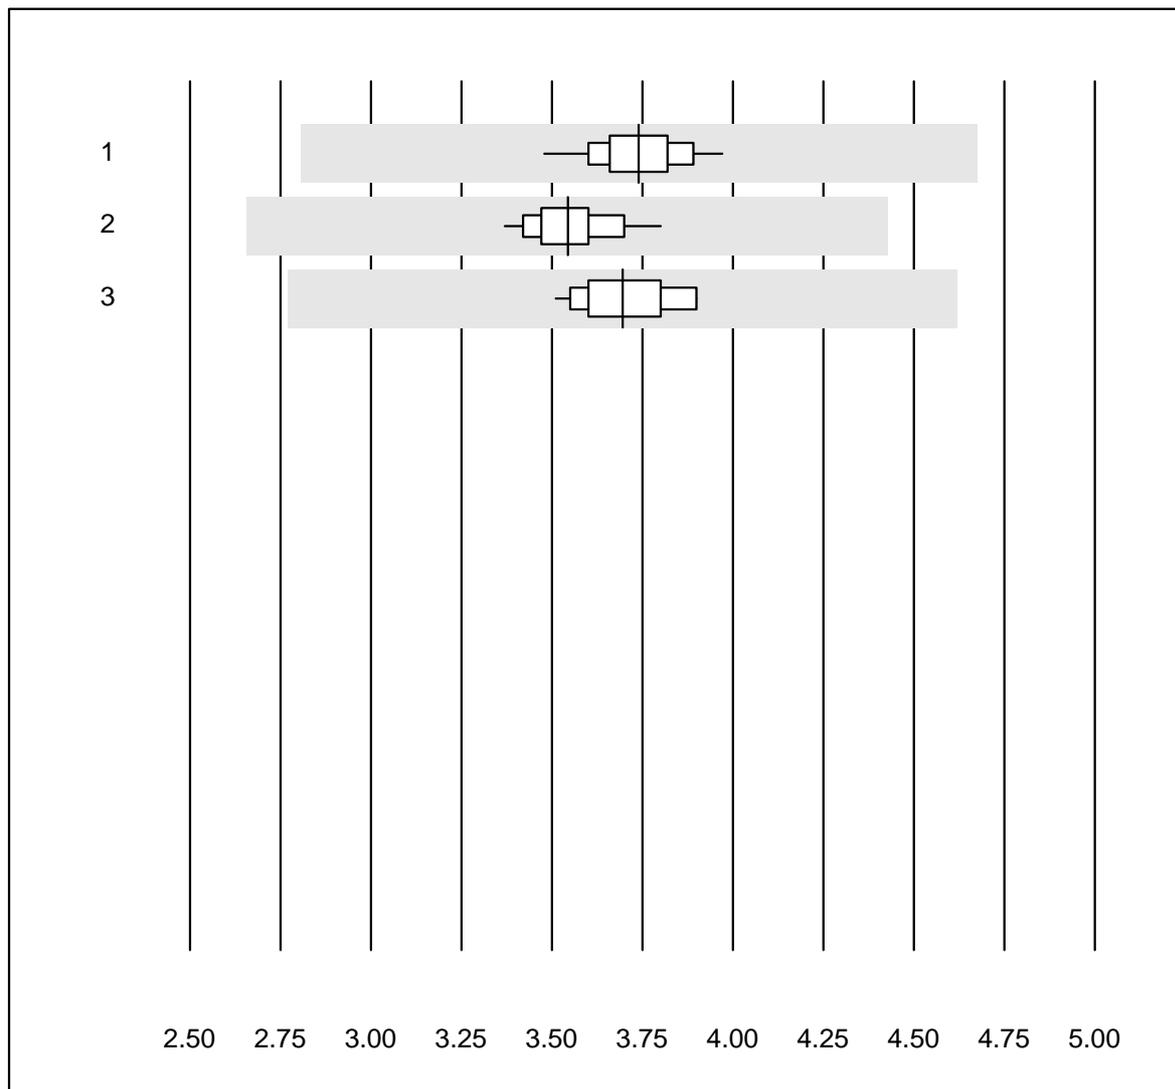


QUALAB Toleranz : 25 %

Leucocytes (G/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex	56	98.2	0.0	1.8	3.74	2.8	e
2	Advia	11	100.0	0.0	0.0	3.54	3.5	e
3	ABX Pentra	14	100.0	0.0	0.0	3.70	3.5	e

Thrombocytes

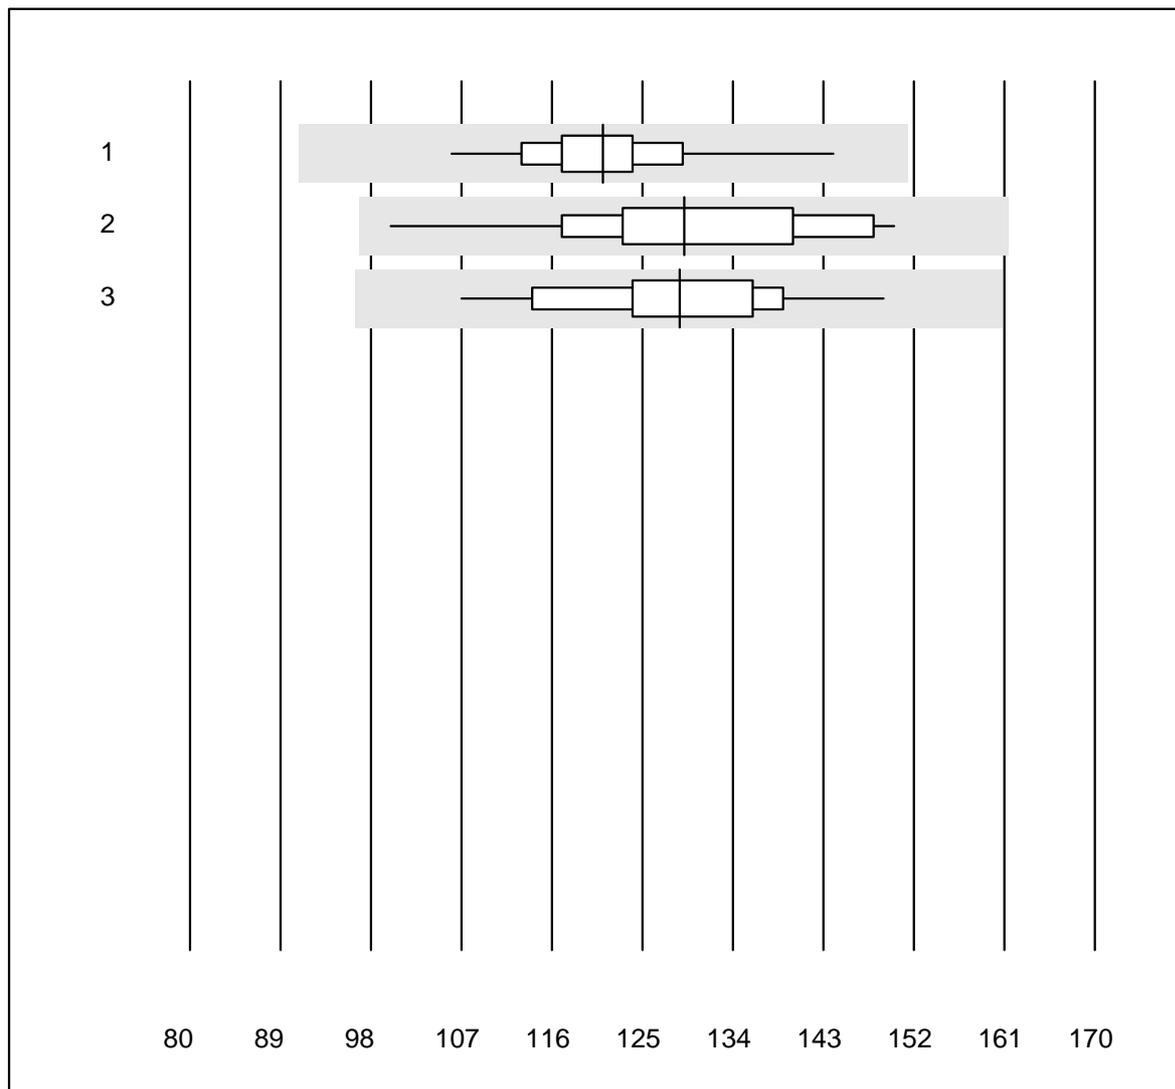


QUALAB Toleranz : 25 %

Thrombocytes (G/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	56	100.0	0.0	0.0	121.1	5.3	e
2 Advia	11	100.0	0.0	0.0	129.2	11.0	e*
3 ABX Pentra	13	100.0	0.0	0.0	128.7	8.4	e

Neutrophiles

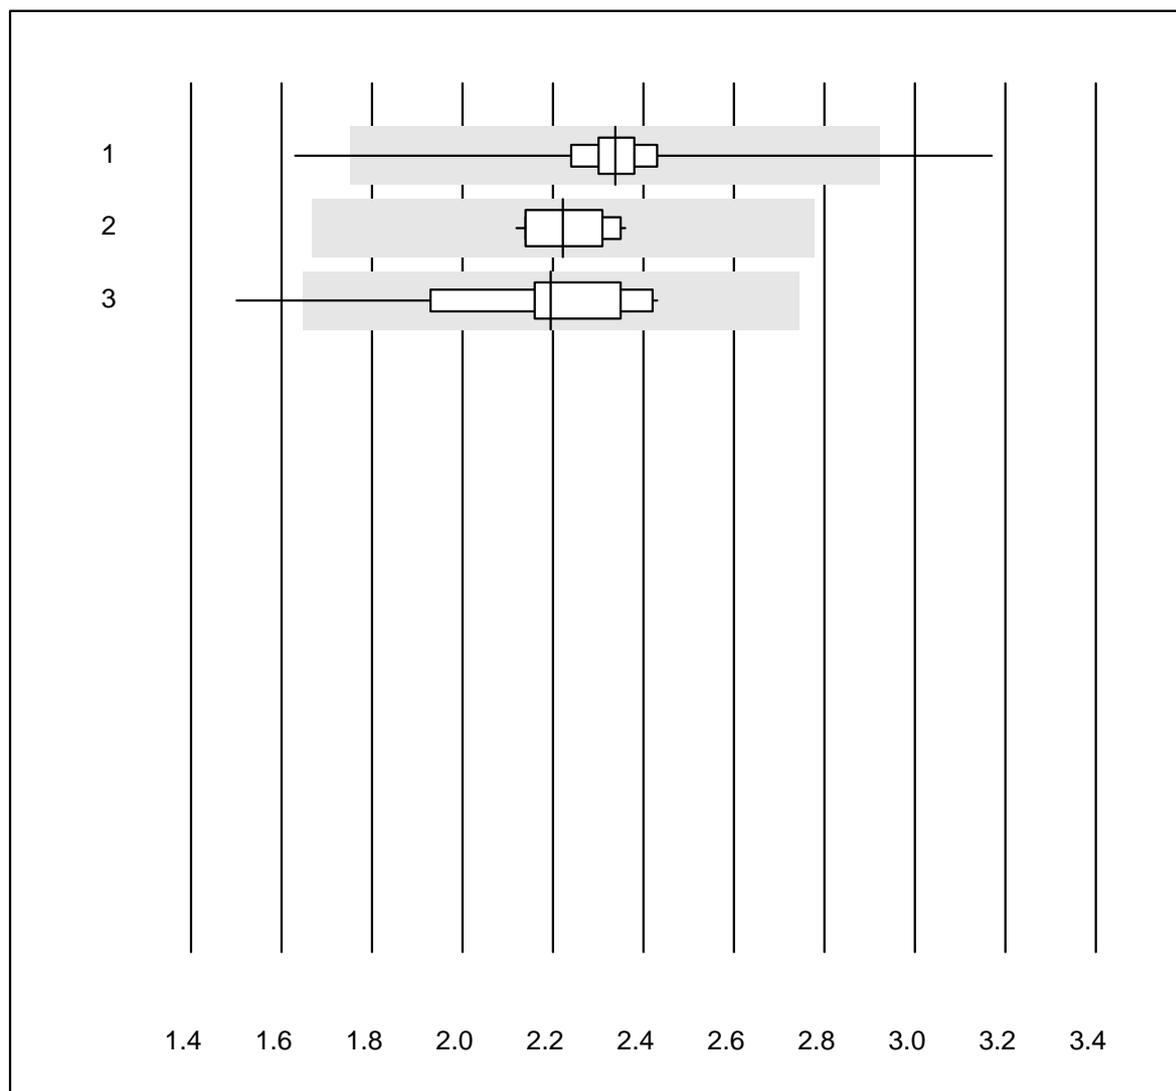


Tolérance MQ : 25 %

Neutrophiles (G/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	56	96.4	3.6	0.0	2.34	7.0	e
2 Advia	11	100.0	0.0	0.0	2.22	3.8	e
3 ABX Pentra	14	92.9	7.1	0.0	2.20	11.3	e*

Lymphocytes

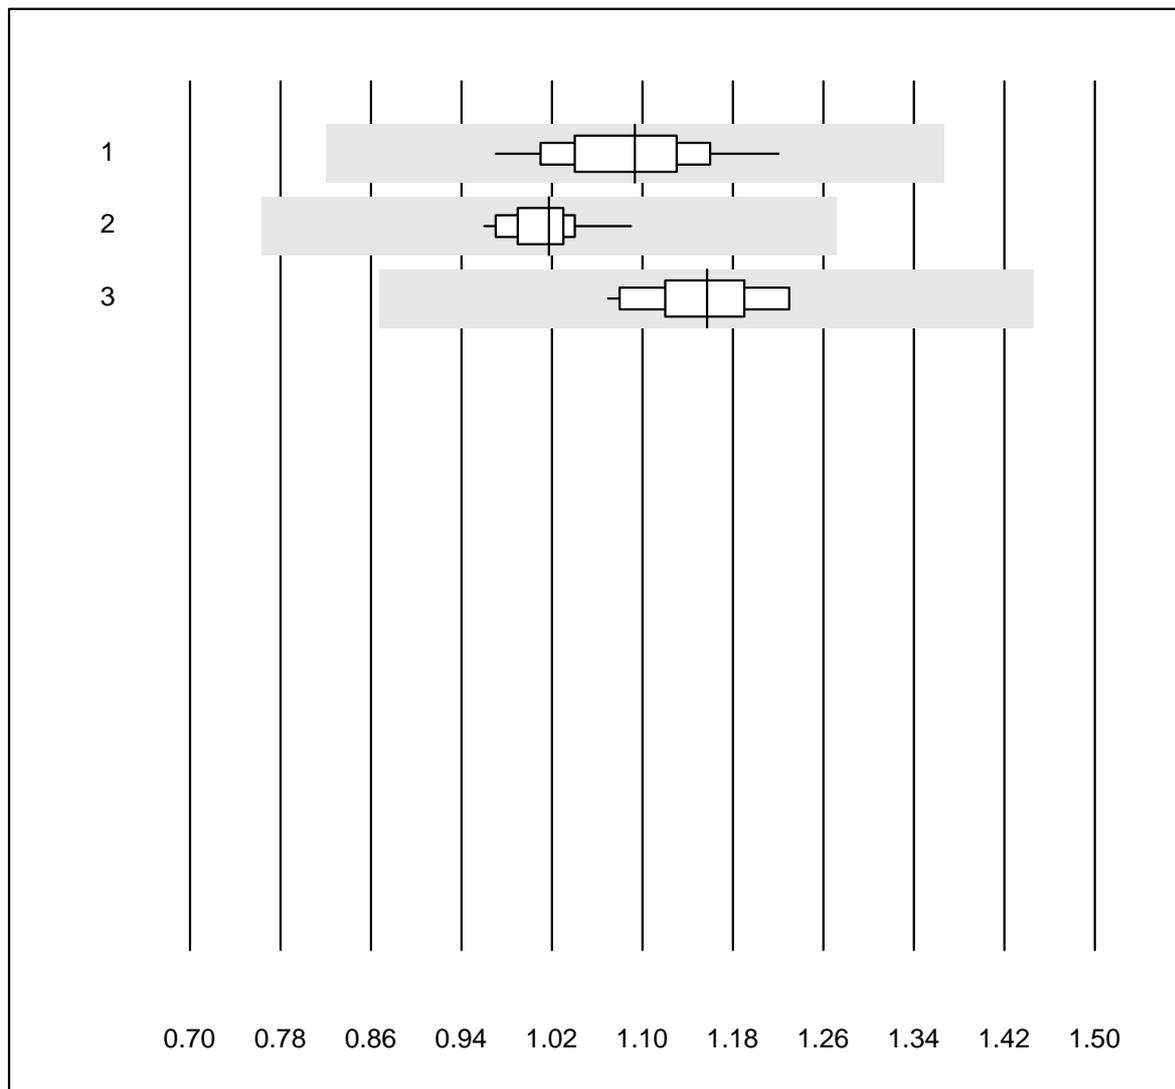


Tolérance MQ : 25 %

Lymphocytes (G/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	56	98.2	0.0	1.8	1.09	5.2	e
2 Advia	11	100.0	0.0	0.0	1.02	3.5	e
3 ABX Pentra	14	92.9	0.0	7.1	1.16	4.4	e

Monocytes

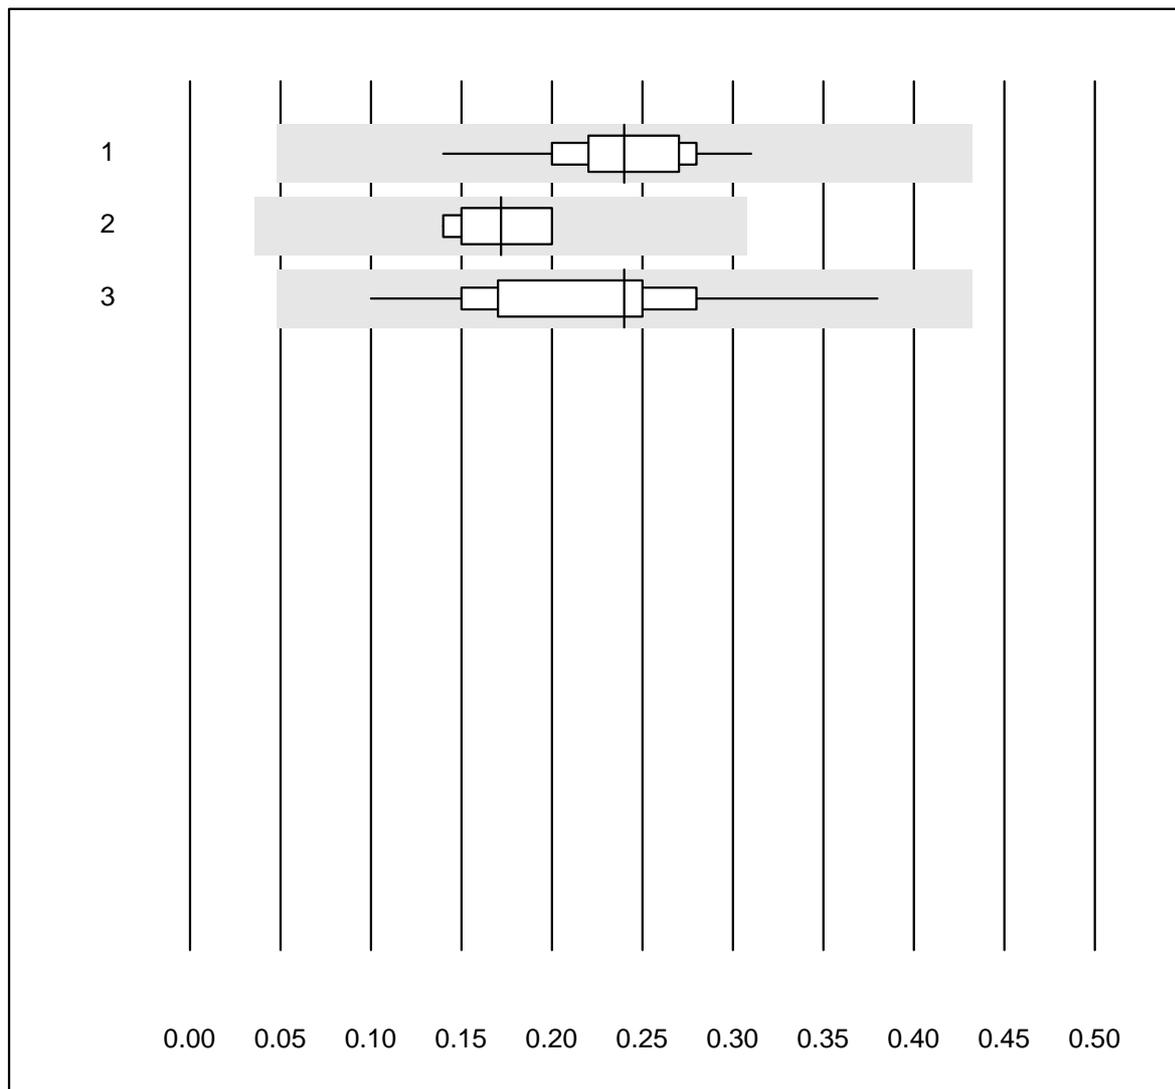


Tolérance MQ : 25 %

Monocytes (G/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	56	98.2	0.0	1.8	0.24	14.1	a
2 Advia	11	100.0	0.0	0.0	0.17	13.7	a
3 ABX Pentra	14	100.0	0.0	0.0	0.24	31.9	a

Eosinophiles

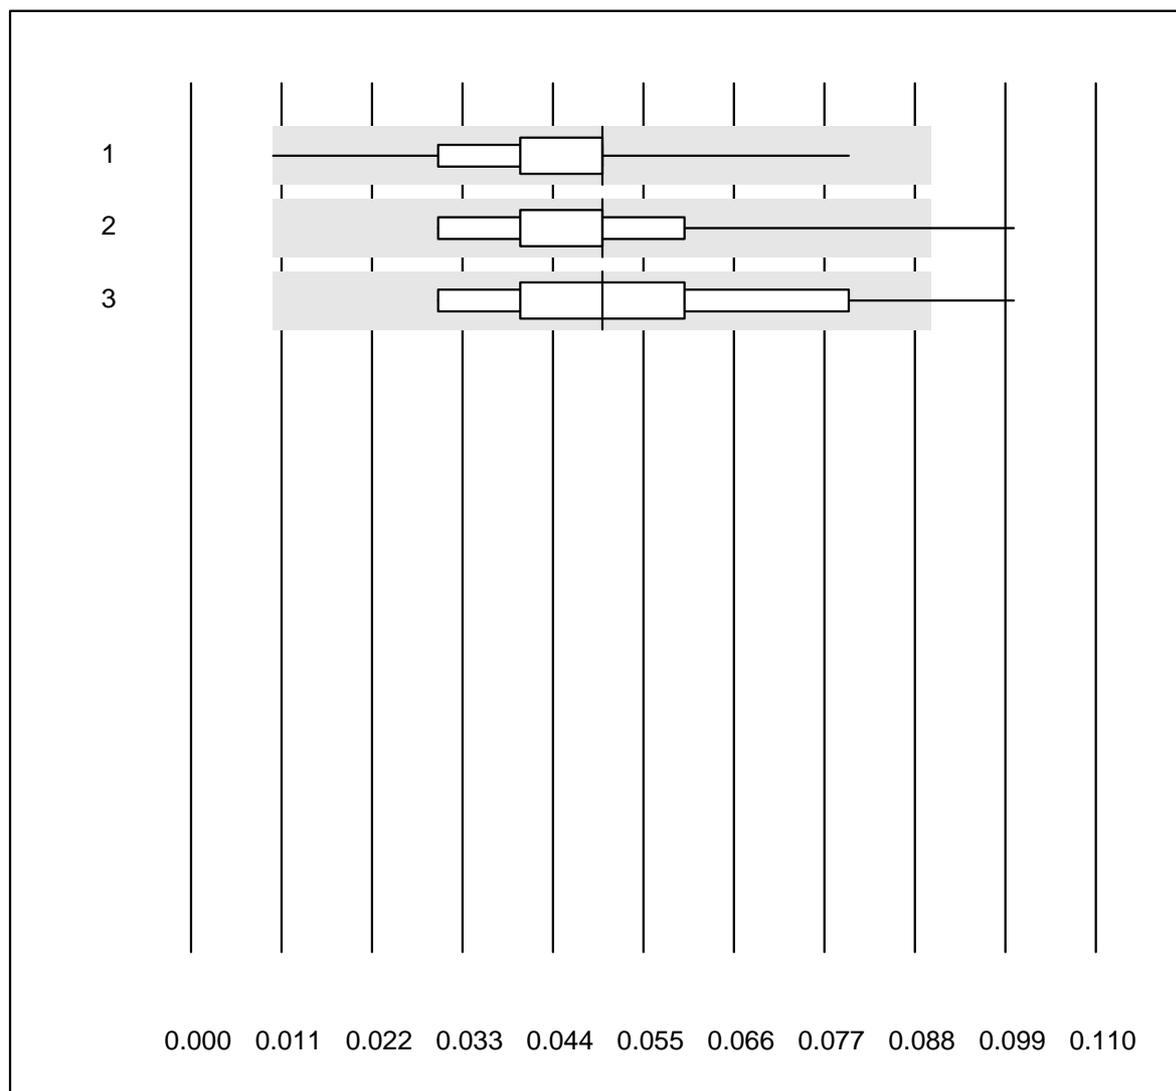


Tolérance MQ : 50 %

Eosinophiles (G/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex	56	94.6	3.6	1.8	0.05	26.0	a
2	Advia	11	81.8	9.1	9.1	0.05	37.5	a
3	ABX Pentra	14	92.9	7.1	0.0	0.05	37.4	a

Basophiles

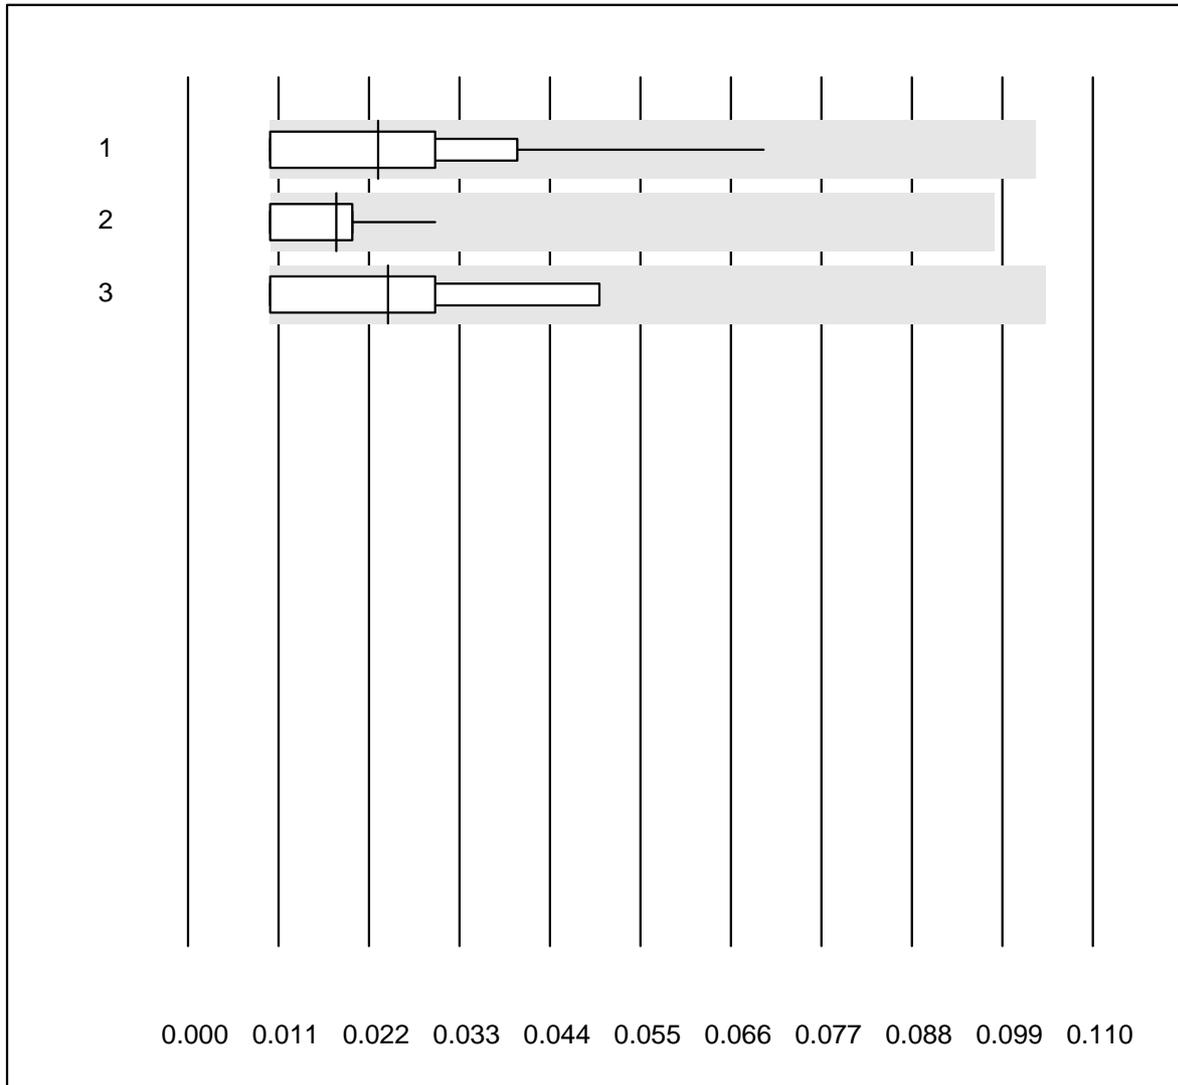


Tolérance MQ : 80 %
 (< 0.10: +/- 0.08 G/l)

Basophiles (G/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	56	98.2	0.0	1.8	0.02	60.6	e
2 Advia	10	100.0	0.0	0.0	0.02	35.1	e*
3 ABX Pentra	14	100.0	0.0	0.0	0.02	59.8	e*

Réticulocytes

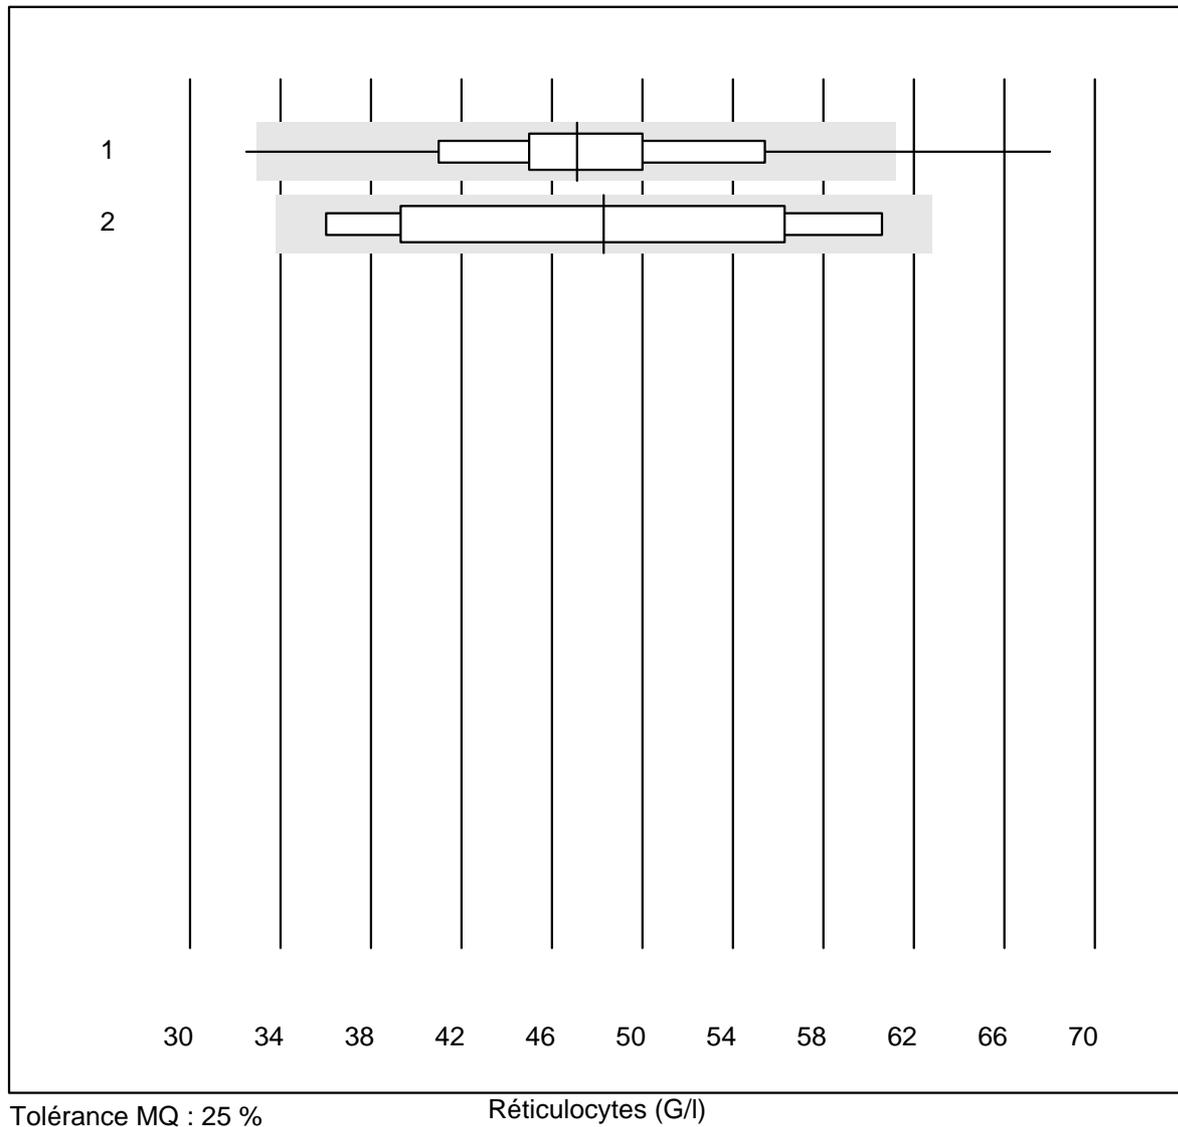

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	33	90.9	9.1	0.0	47.1	14.9	a
2 Advia	8	87.5	0.0	12.5	48.3	19.3	a

Index hémolytique échantillon A

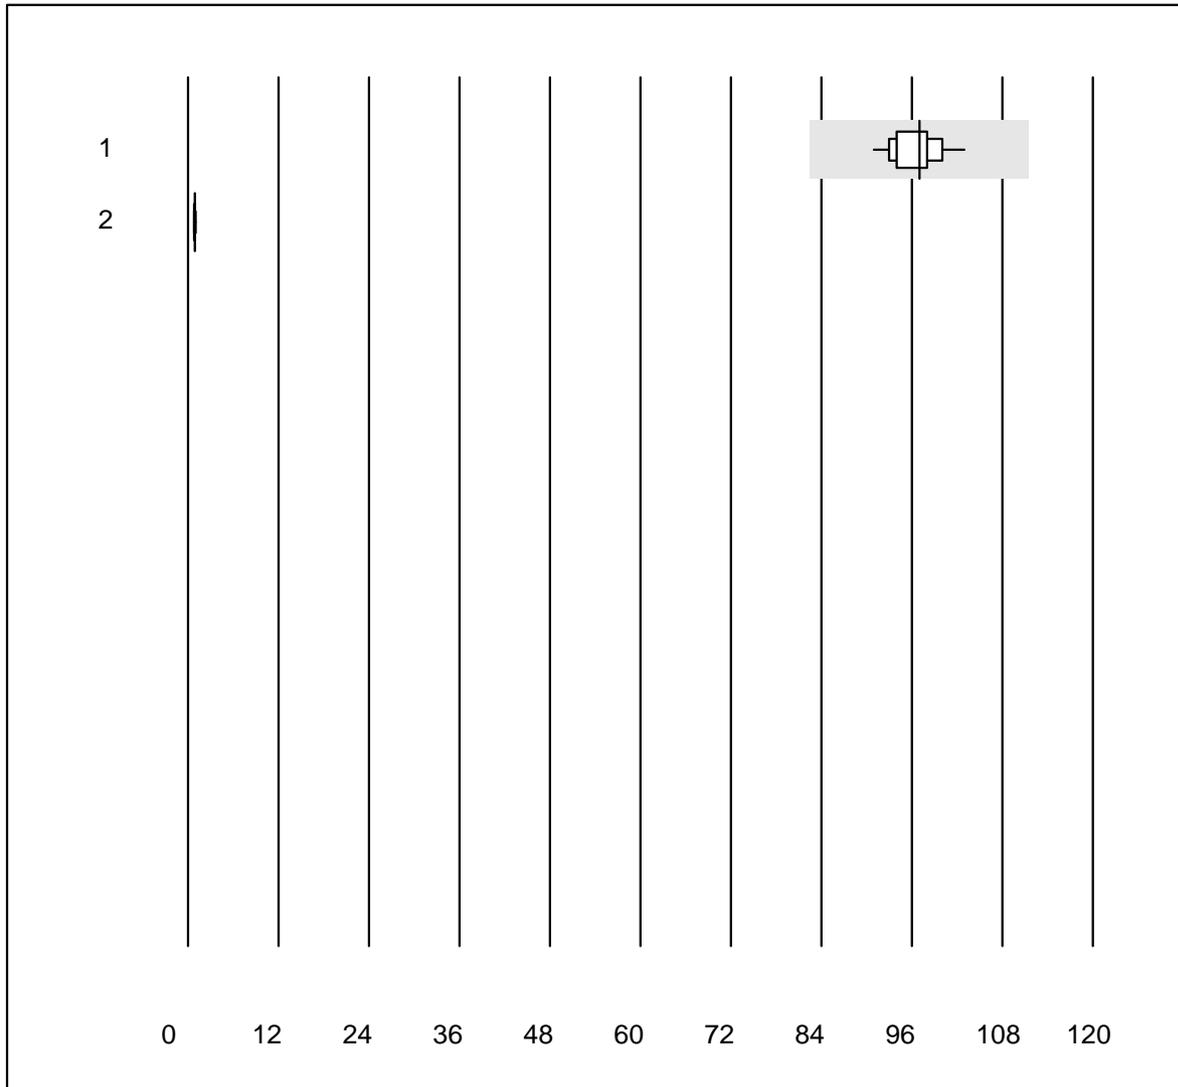


Tolérance MQ : 15 %

Index hémolytique échantillon A ()

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	13	92.3	0.0	7.7	97.00	3.5	e
2 Architect	4	75.0	25.0	0.0	0.87	10.5	e*

Index hémolytique échantillon B

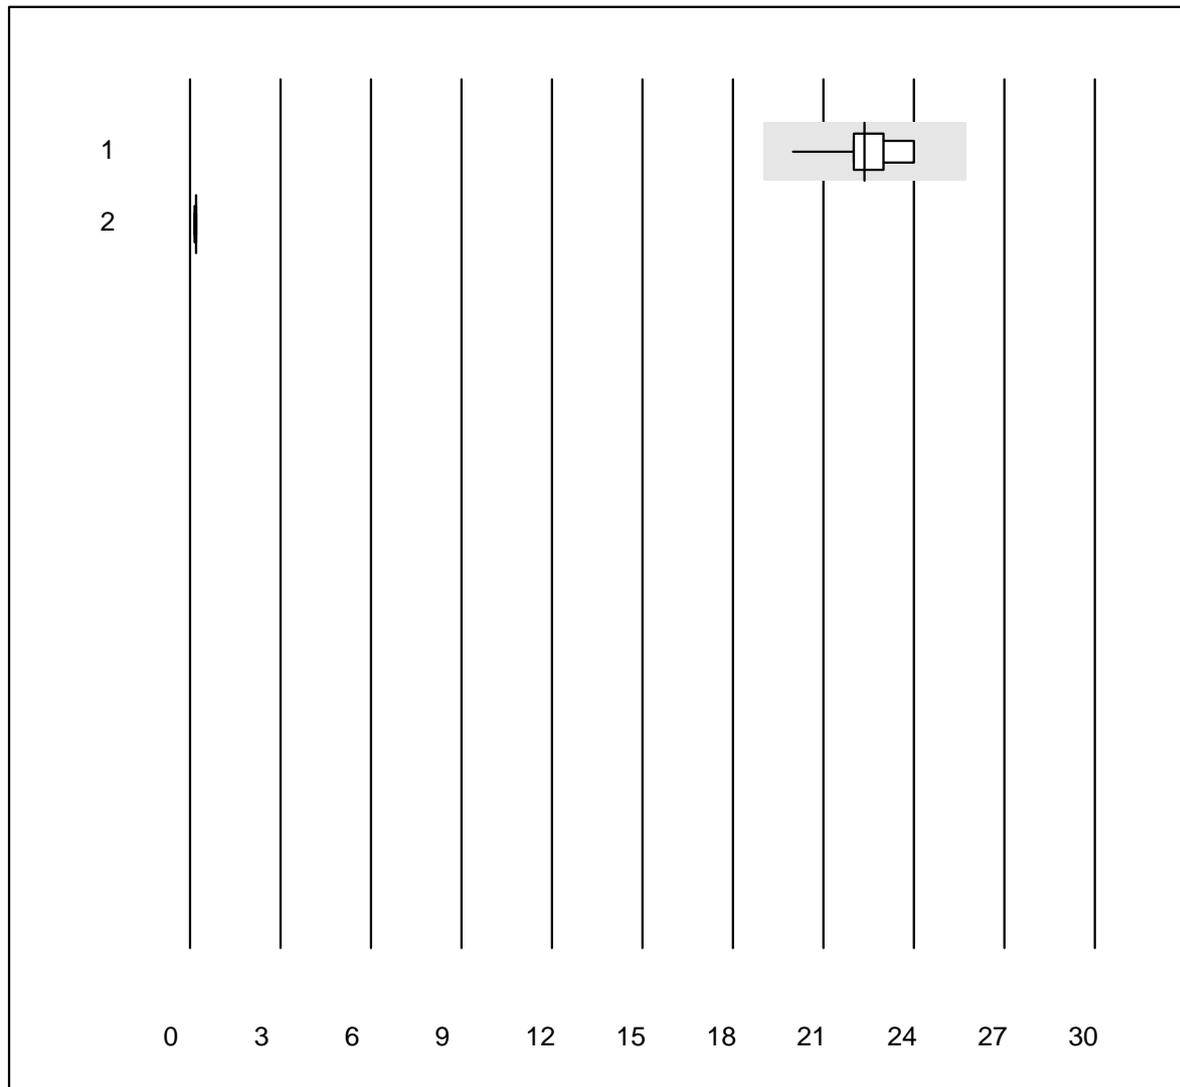


Tolérance MQ : 15 %

Index hémolytique échantillon B ()

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	13	84.6	0.0	15.4	22.36	5.0	e
2 Architect	4	75.0	25.0	0.0	0.19	8.2	a

Vitesse de sédimentation 1h

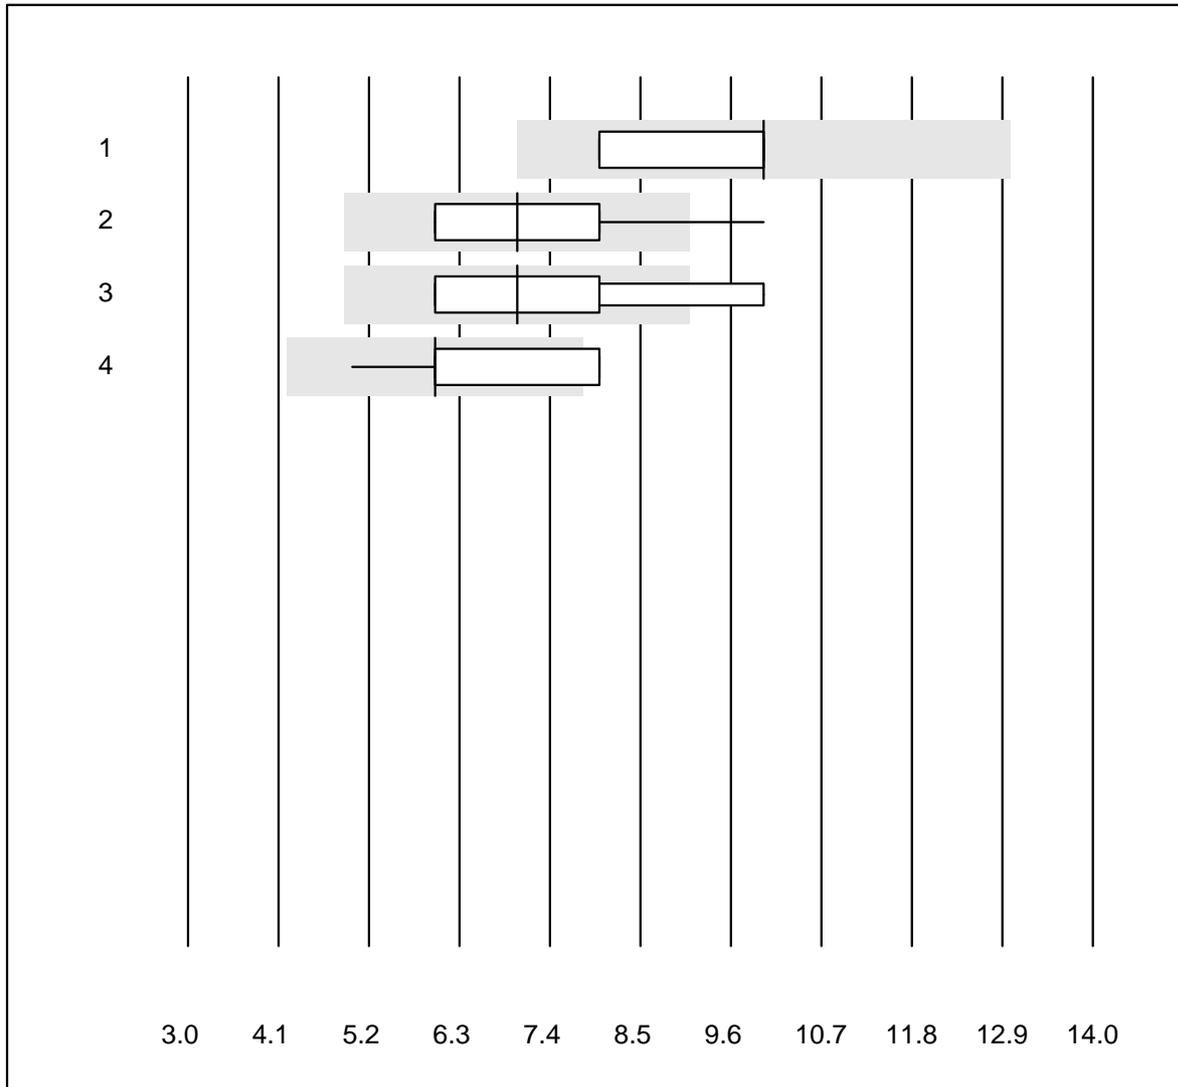


Tolérance MQ : 30 %

Vitesse de sédimentation 1h (mm/h)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	MINI-CUBE	6	66.7	0.0	33.3	10	10.4	e*
2	Sarstedt Sedivette	12	83.4	8.3	8.3	7	19.2	a
3	Sarstedt Microvette	4	75.0	25.0	0.0	7	25.5	e*
4	BD Seditainer	22	68.2	27.3	4.5	6	15.2	a

Vitesse de sédimentation 2h

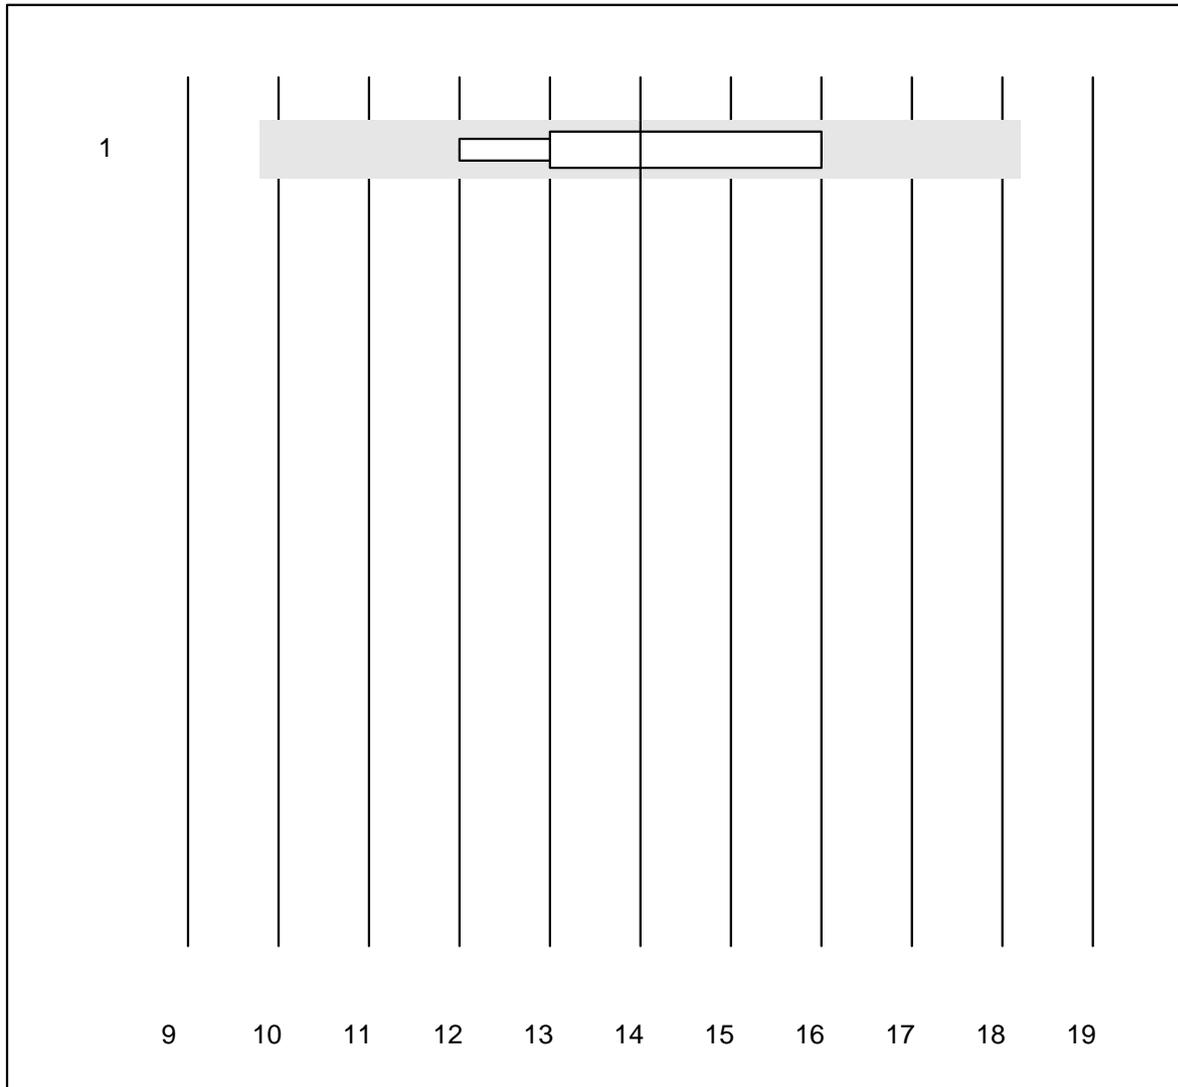


Tolérance MQ : 30 %

Vitesse de sédimentation 2h (mm/2h)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	BD Seditainer	6	100.0	0.0	0.0	14	12.0	a

CRP

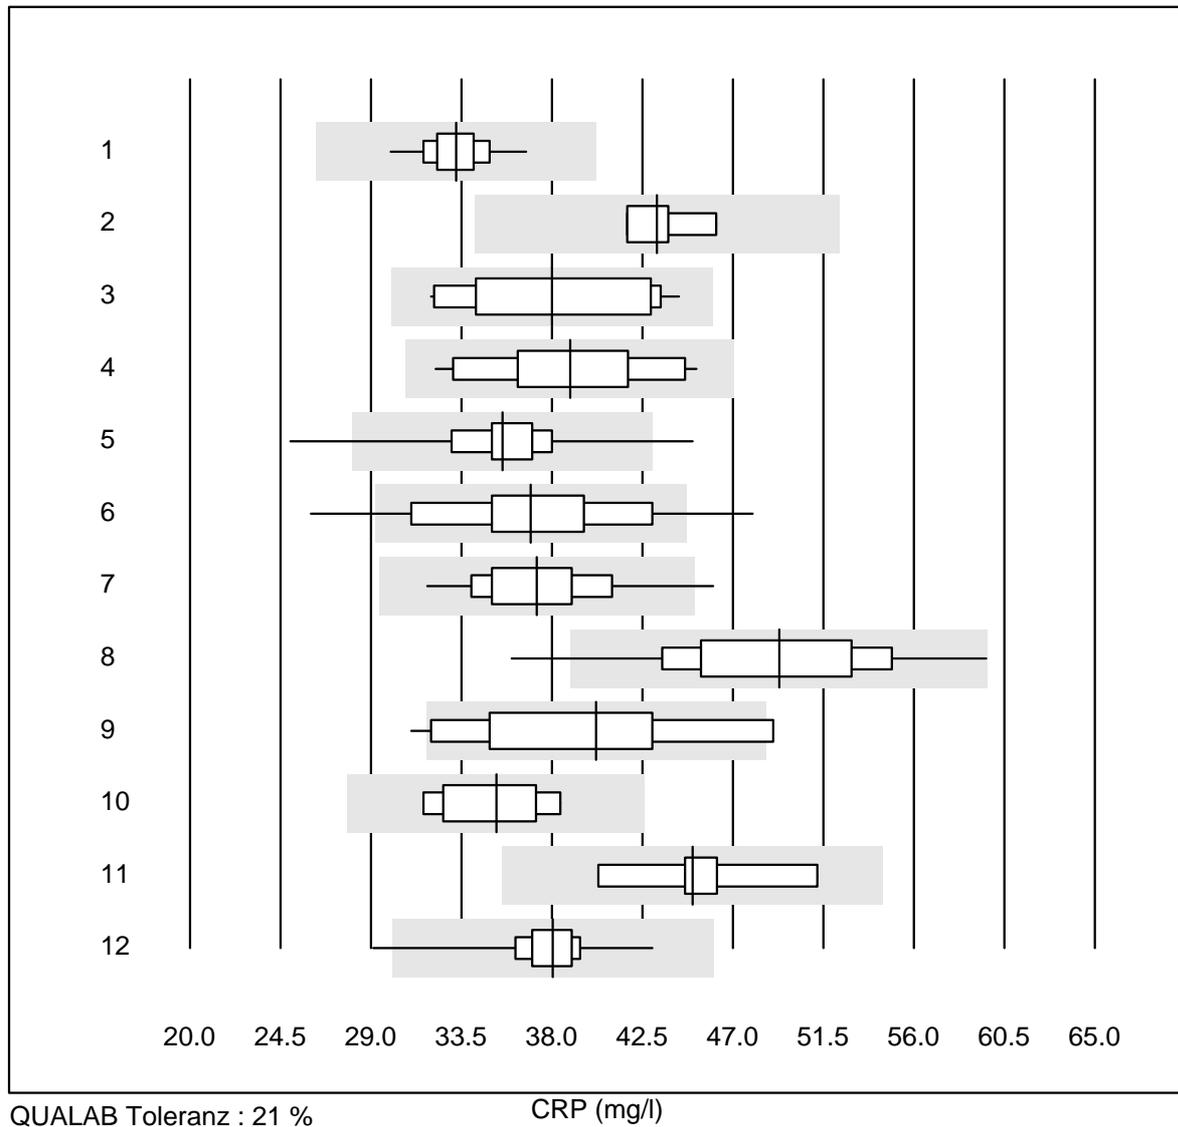


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas b101	184	99.5	0.0	0.5	33.2	3.8	e
2	IChroma	4	100.0	0.0	0.0	43.2	4.4	e
3	Cobas	19	100.0	0.0	0.0	38.0	11.4	e*
4	Turbidimetrie	19	89.5	0.0	10.5	38.9	9.5	e
5	Afinion	1323	97.8	2.1	0.1	35.5	6.2	e
6	NycoCard SingleTest-	161	78.8	10.6	10.6	36.9	12.1	e
7	Quick Read go	114	98.2	0.9	0.9	37.3	7.8	e
8	Eurolyser	110	80.0	1.8	18.2	49.3	9.7	e
9	Fuji Dri-Chem	15	60.0	20.0	20.0	40.2	15.0	e*
10	Autolyser/DiaSys	10	70.0	0.0	30.0	35.2	7.2	e
11	Piccolo	6	83.3	0.0	16.7	45.0	8.6	e*
12	Celltac chemi	42	92.8	2.4	4.8	38.0	5.5	e

CRP

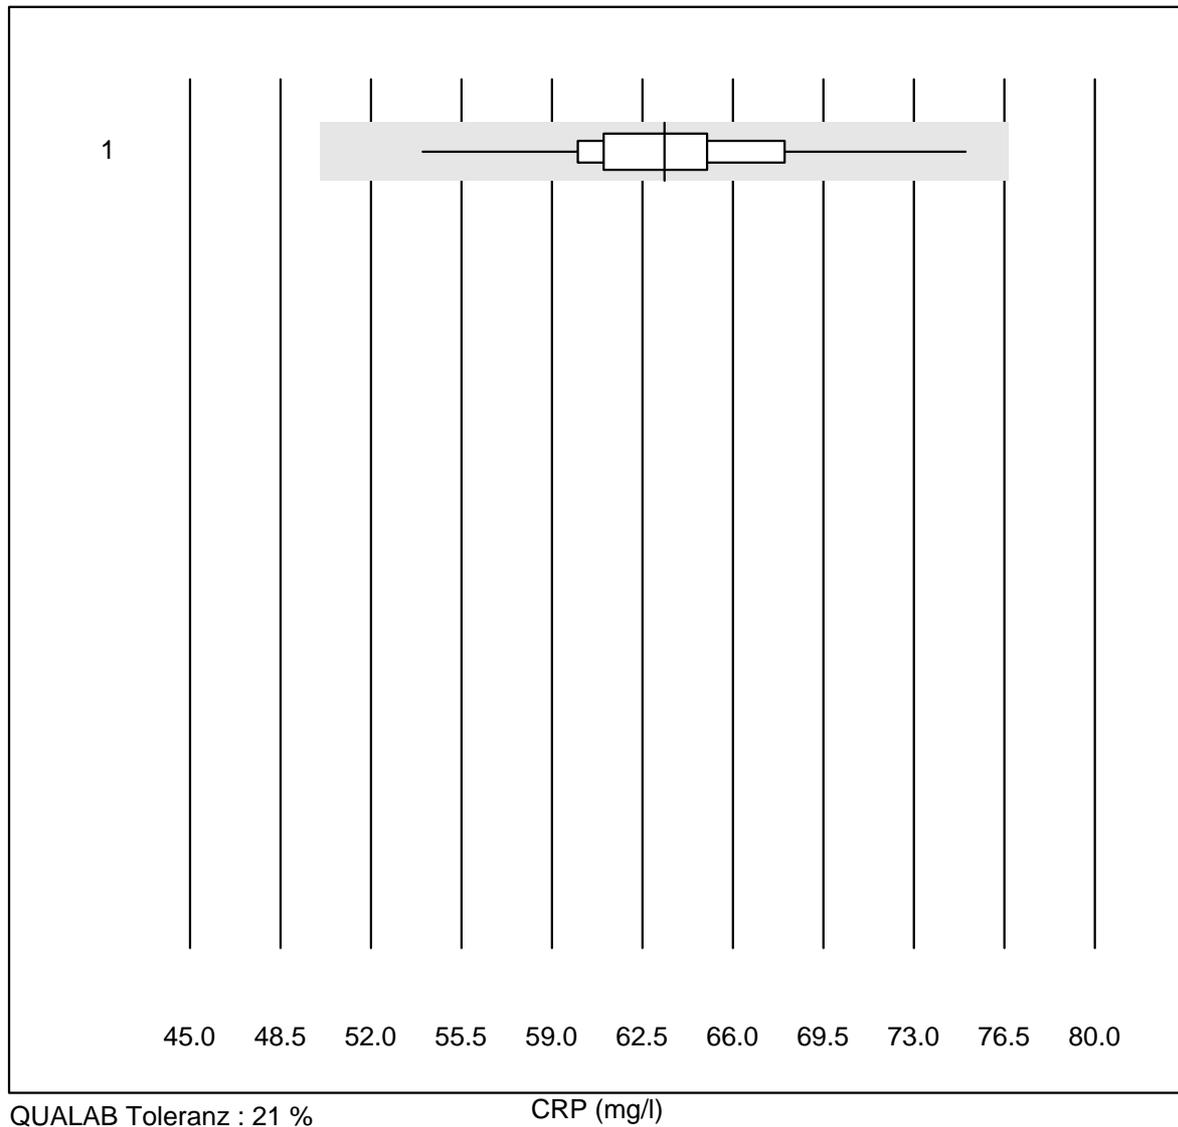


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	QuickRead (sang comp	54	96.3	0.0	3.7	63.3	6.0	e

CRP

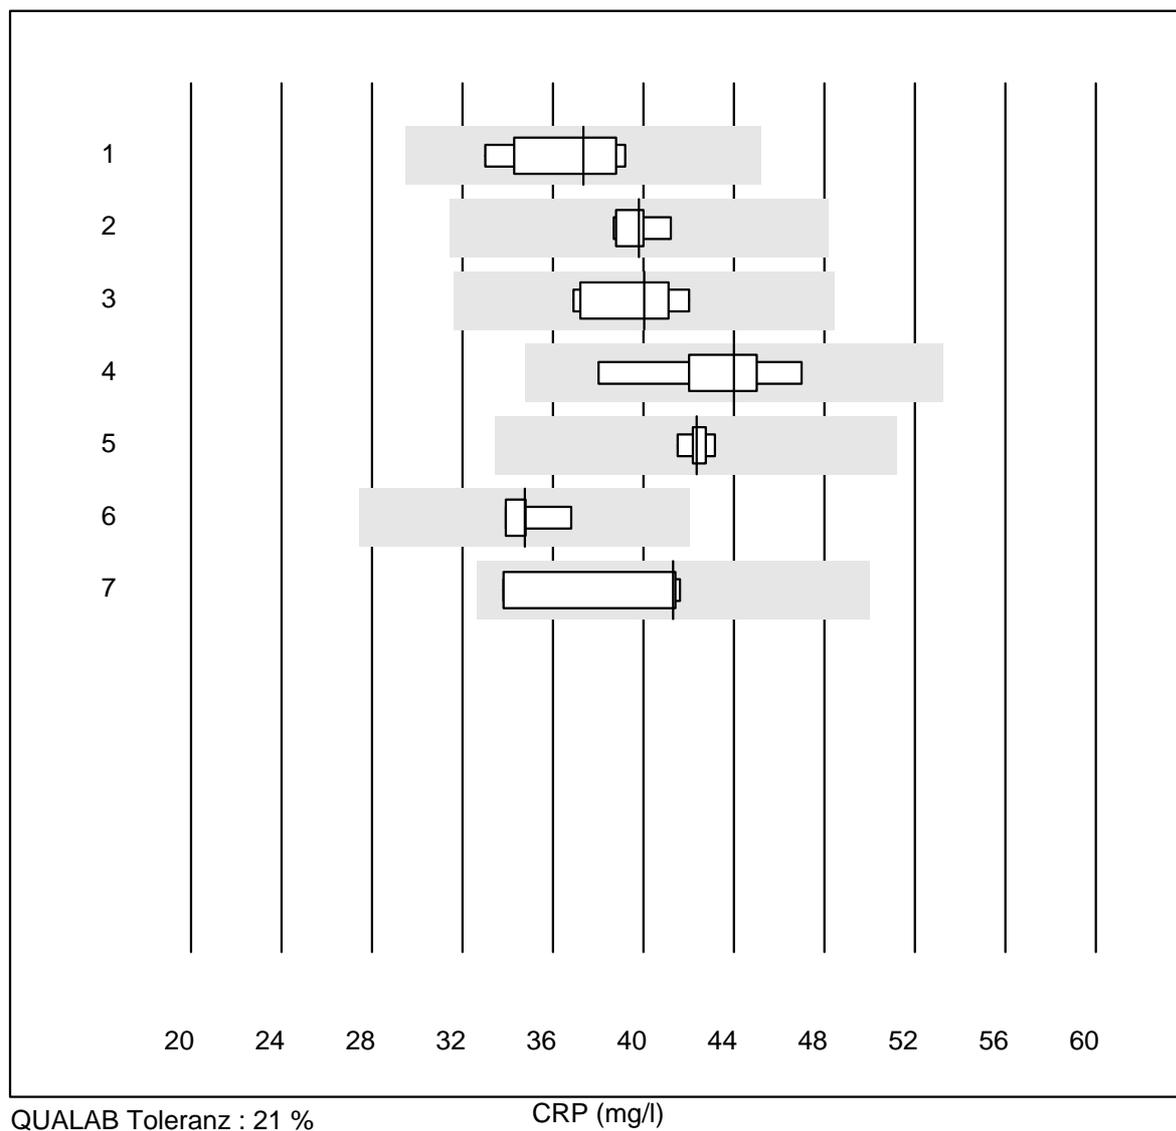

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Spinit	8	87.5	0.0	12.5	37.4	6.2	e
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	39.8	2.6	e
3 Beckman	8	100.0	0.0	0.0	40.1	5.3	e
4 AQT 90 FLEX	7	100.0	0.0	0.0	44.0	6.6	e
5 Spotchem D-Concept	6	83.3	0.0	16.7	42.4	1.5	e
6 Spotchem SI-3510	4	100.0	0.0	0.0	34.8	3.5	e
7 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	41.3	9.6	e*

IgG

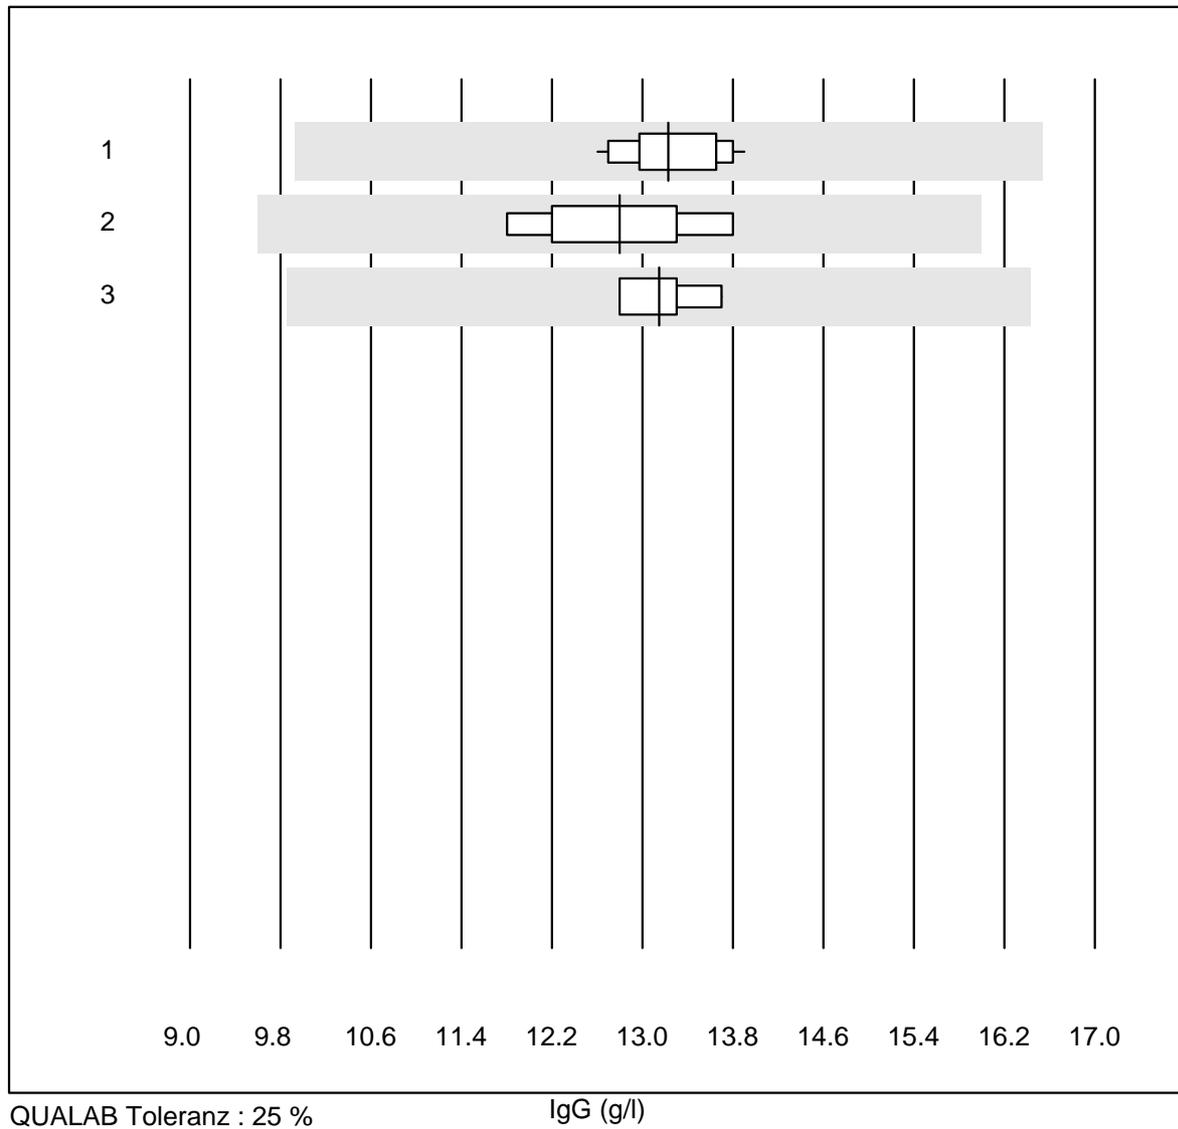


QUALAB Toleranz : 25 %

IgG (g/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Turbidimetrie	13	100.0	0.0	0.0	13.2	3.3	e
2 Nephelometrie	5	100.0	0.0	0.0	12.8	6.3	e
3 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	13.2	3.0	e

IgA

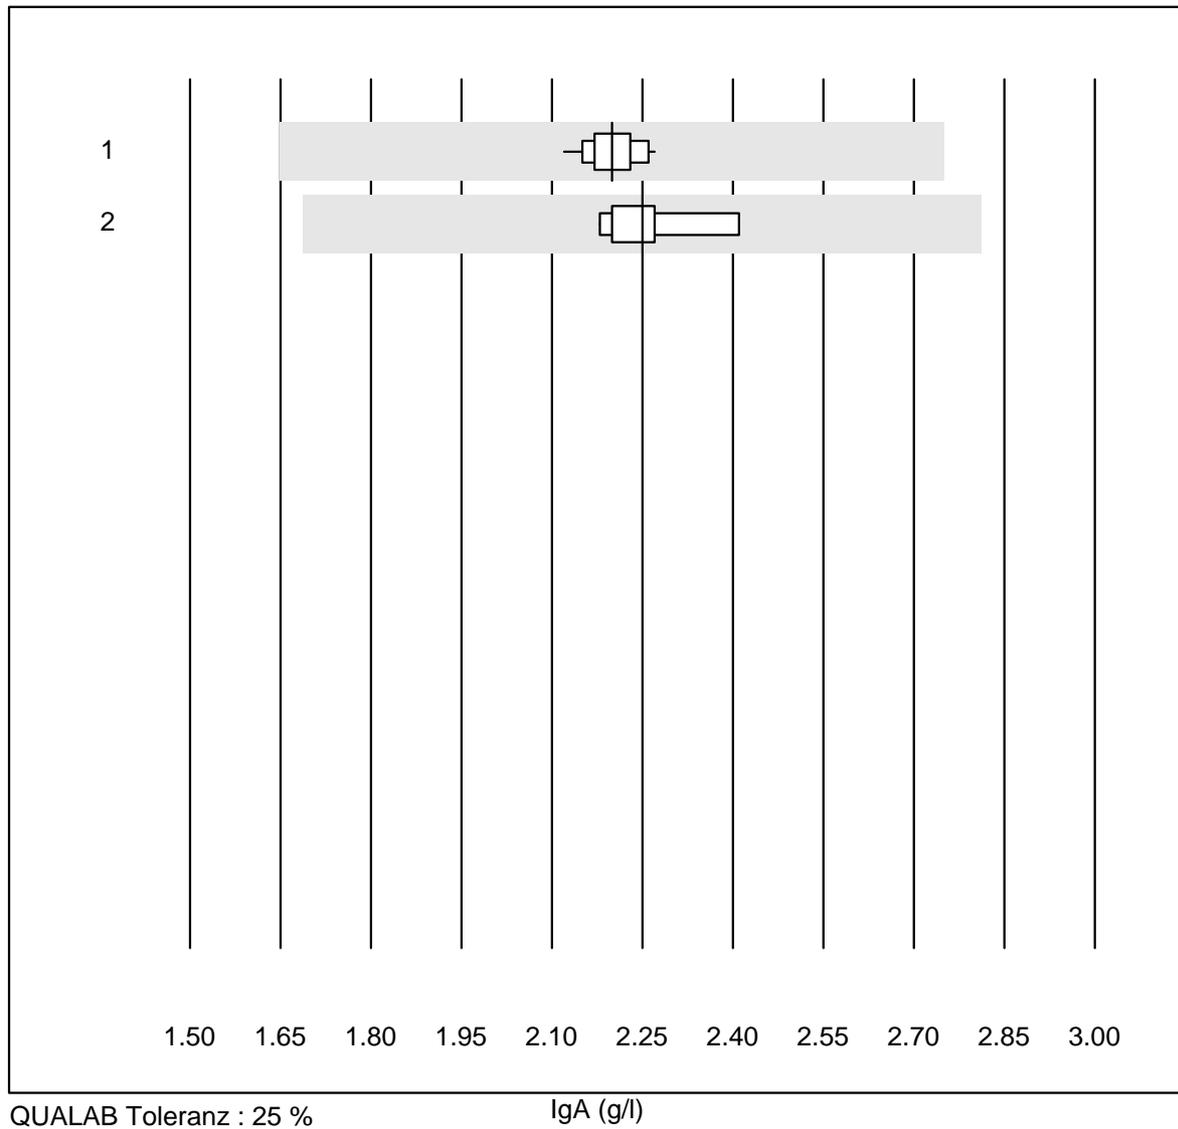


QUALAB Toleranz : 25 %

IgA (g/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Turbidimetrie	14	100.0	0.0	0.0	2.2	2.0	e
2	Nephelometrie	5	100.0	0.0	0.0	2.3	4.0	e

IgM

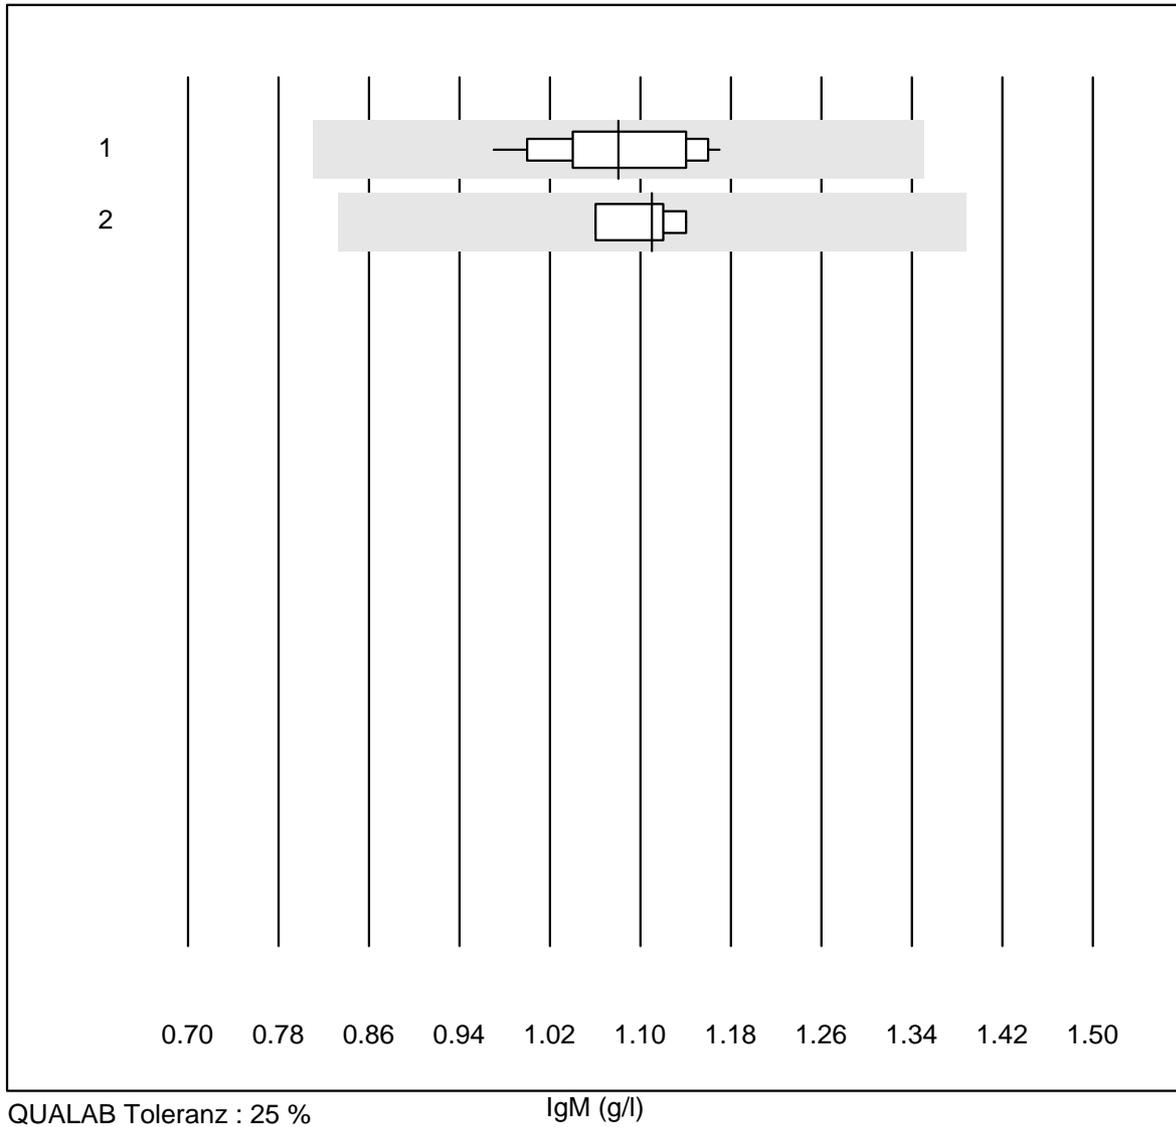


QUALAB Toleranz : 25 %

IgM (g/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Turbidimetrie	15	100.0	0.0	0.0	1.1	5.7	e
2	Nephelometrie	4	100.0	0.0	0.0	1.1	3.1	e

IgE

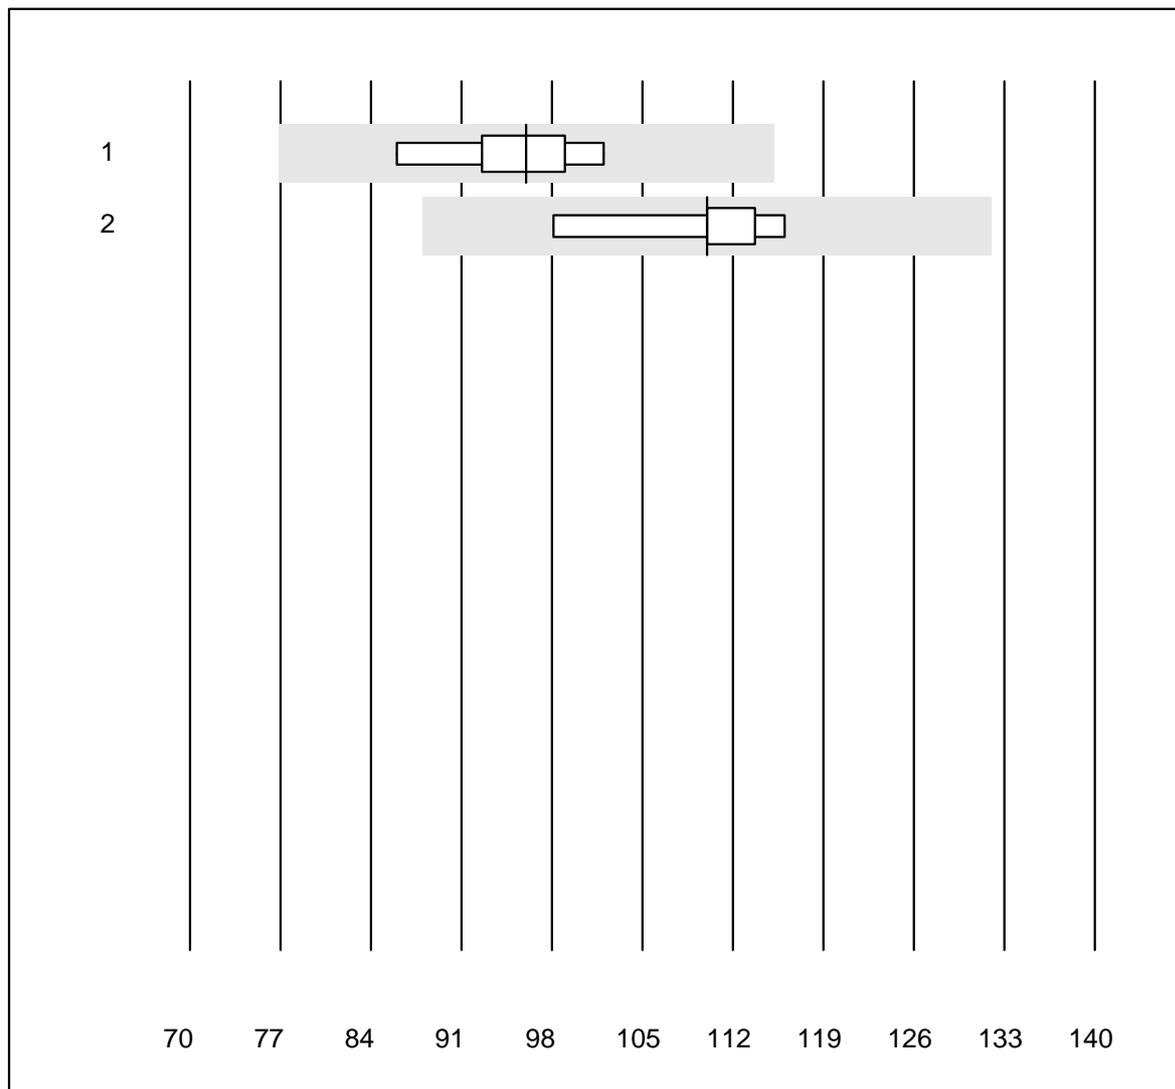


QUALAB Toleranz : 20 %

IgE (kU/L)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	96	6.5	e*
2	Cobas	5	100.0	0.0	0.0	110	6.3	e*

Alpha-1-Antitrypsine

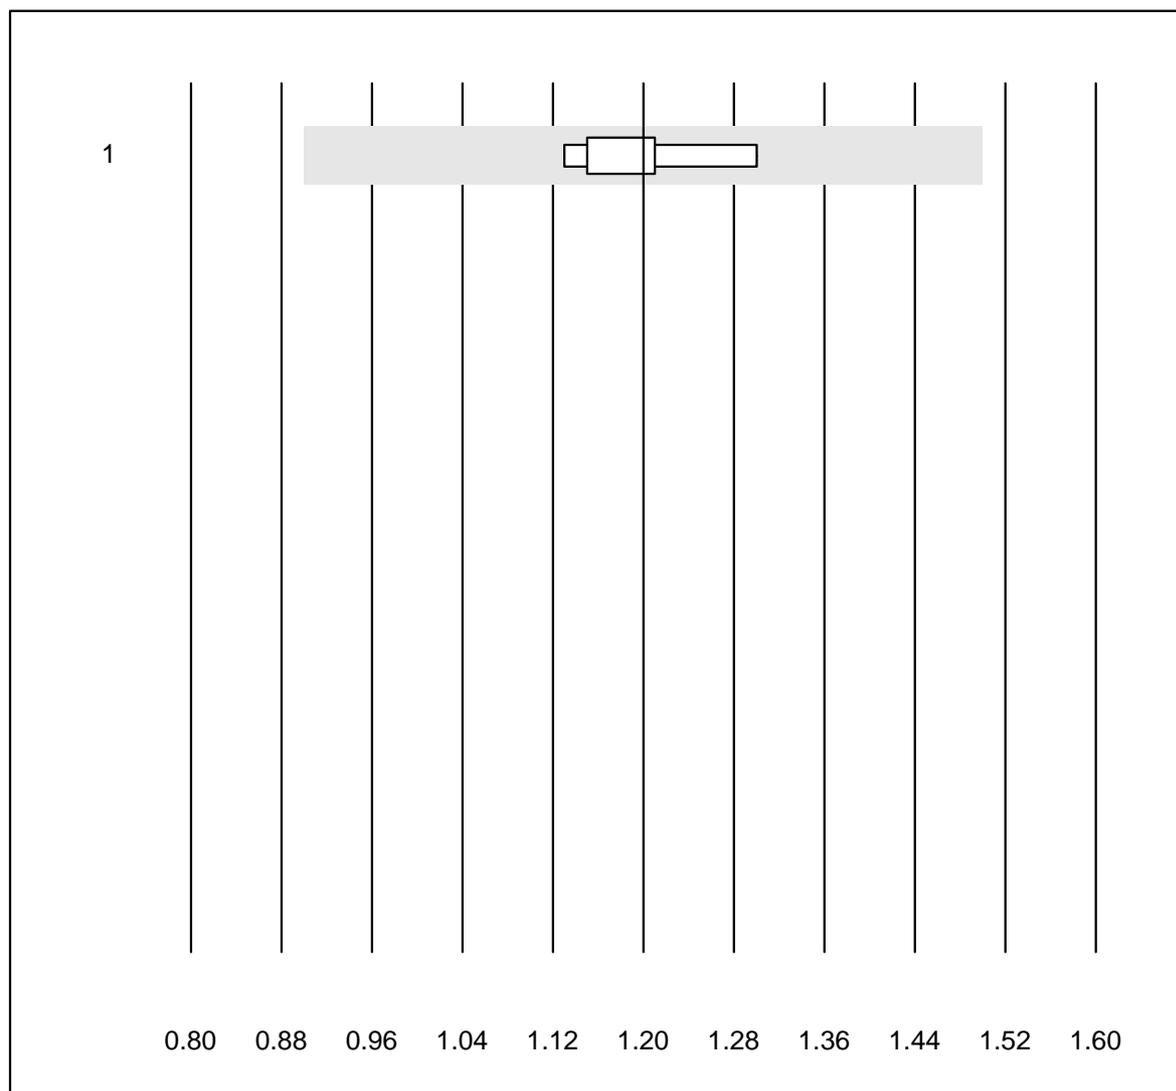


Tolérance MQ : 25 %

Alpha-1-Antitrypsine (g/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	1.20	4.7	a

Anti-Streptolysine-Anticorps

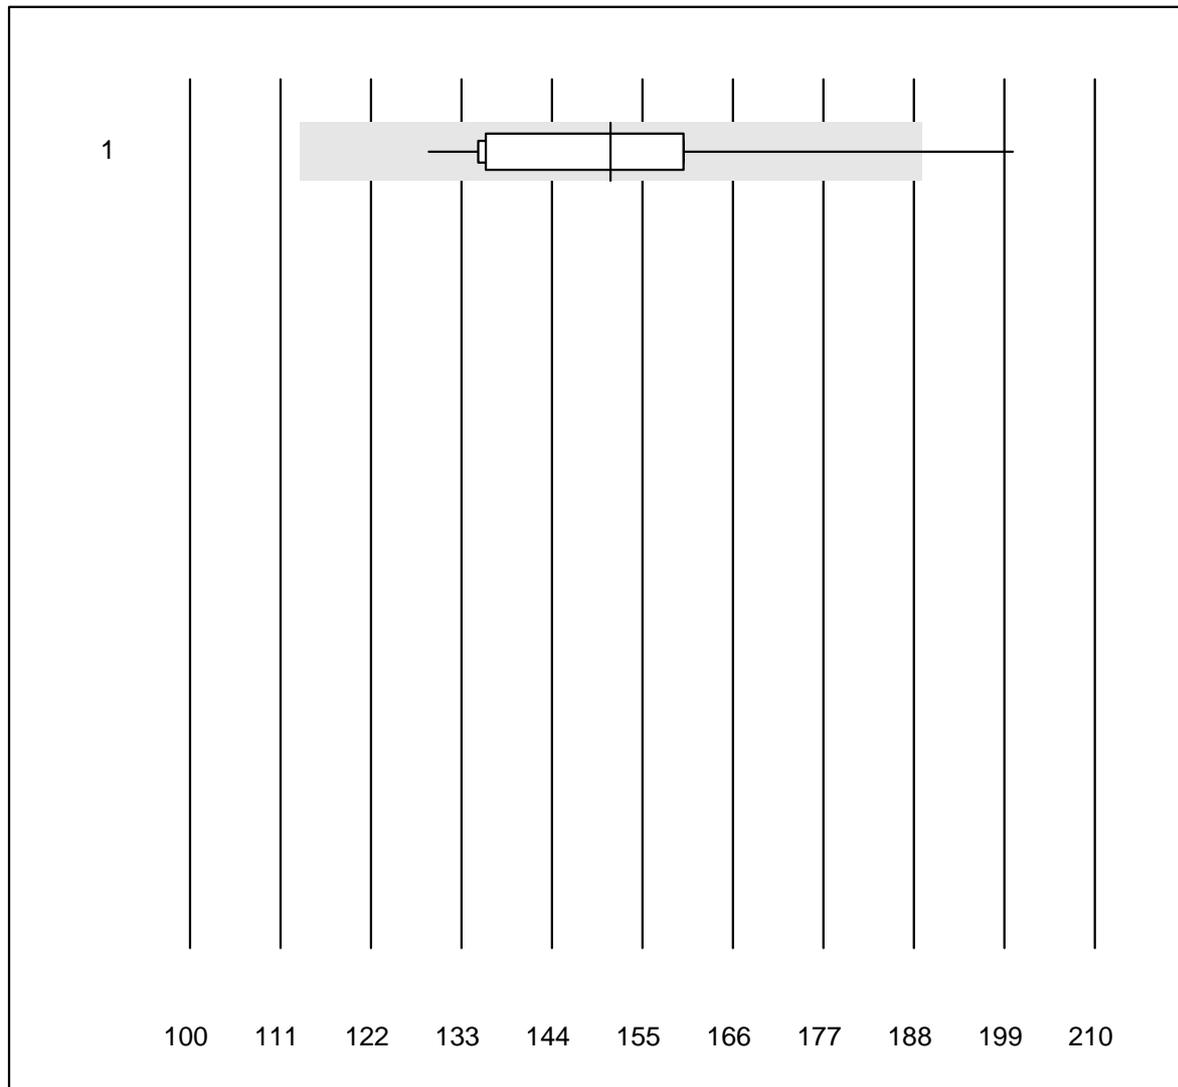


Tolérance MQ : 25 %

Anti-Streptolysine-Anticorps (kIU/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	11	90.9	9.1	0.0	151	12.8	a

Complément C3

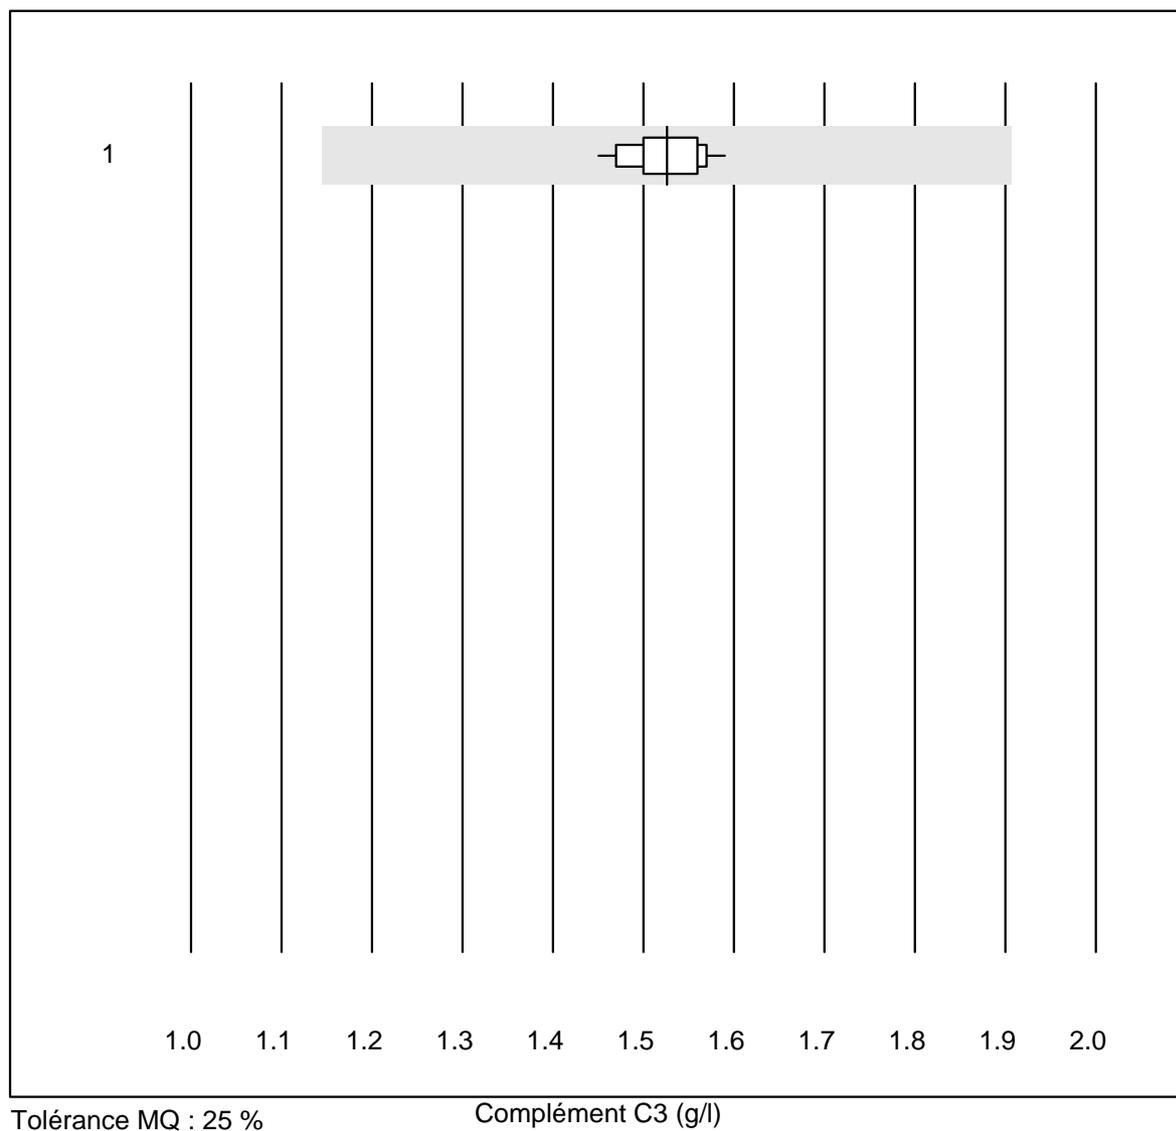


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	14	100.0	0.0	0.0	1.53	2.8	e

Complément C4

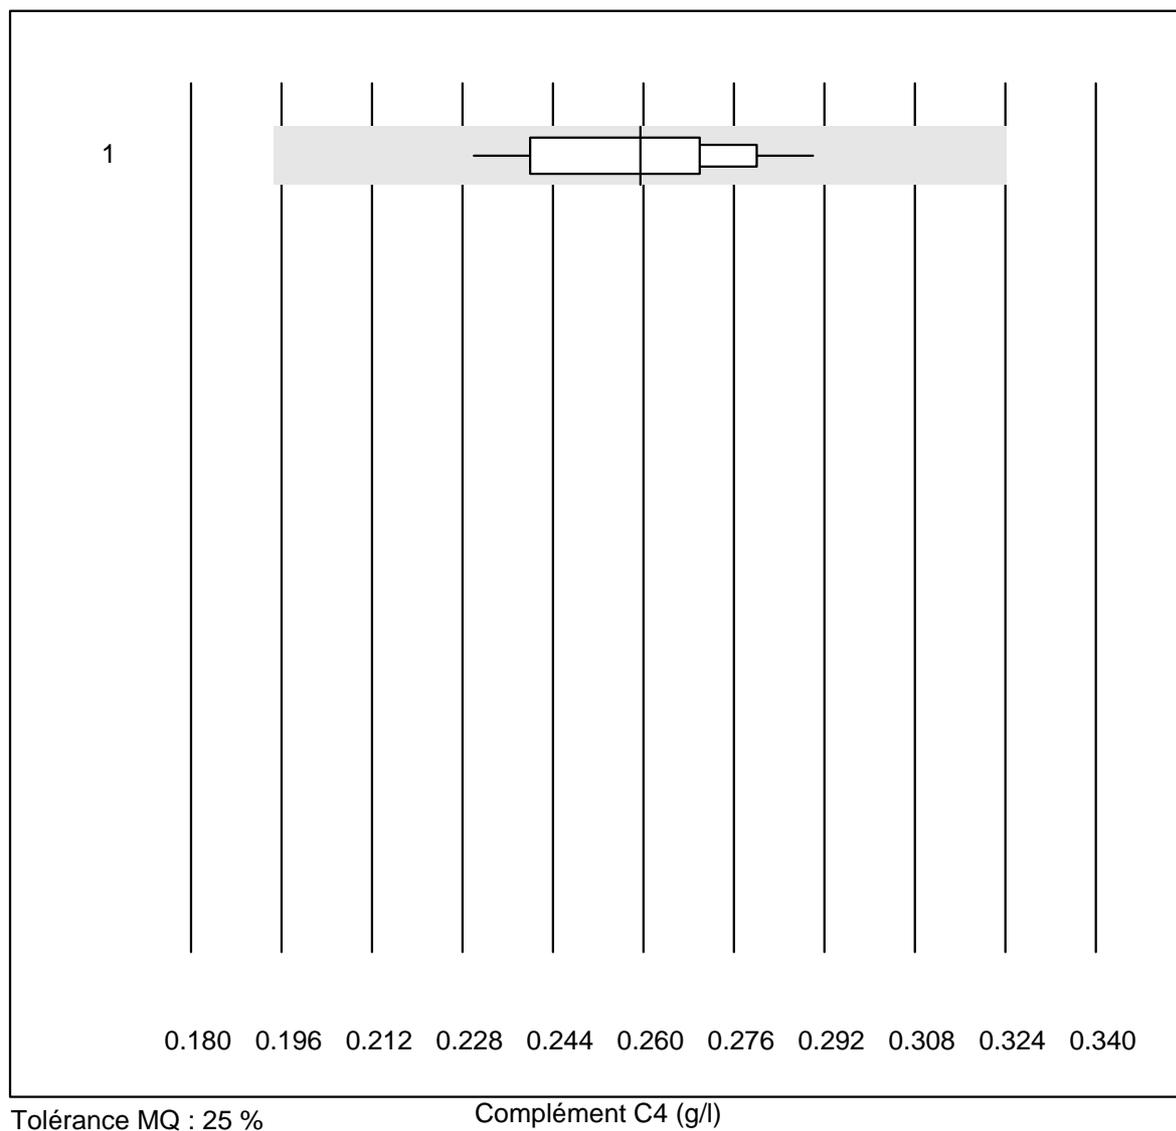


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	13	100.0	0.0	0.0	0.26	7.2	e

Haptoglobine

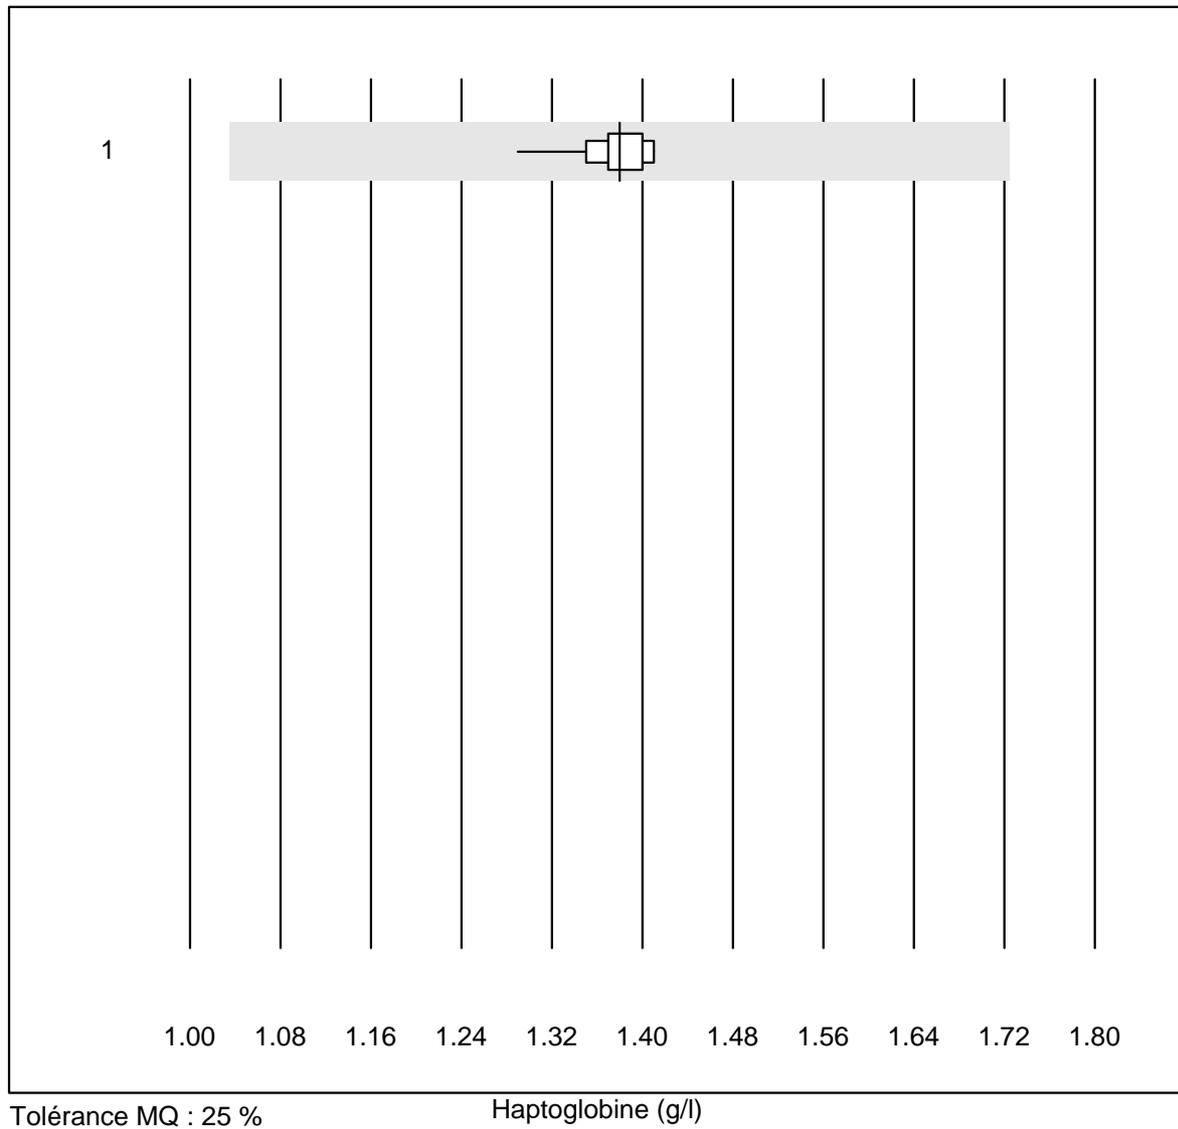


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	15	100.0	0.0	0.0	1.38	2.2	e

Transferrine

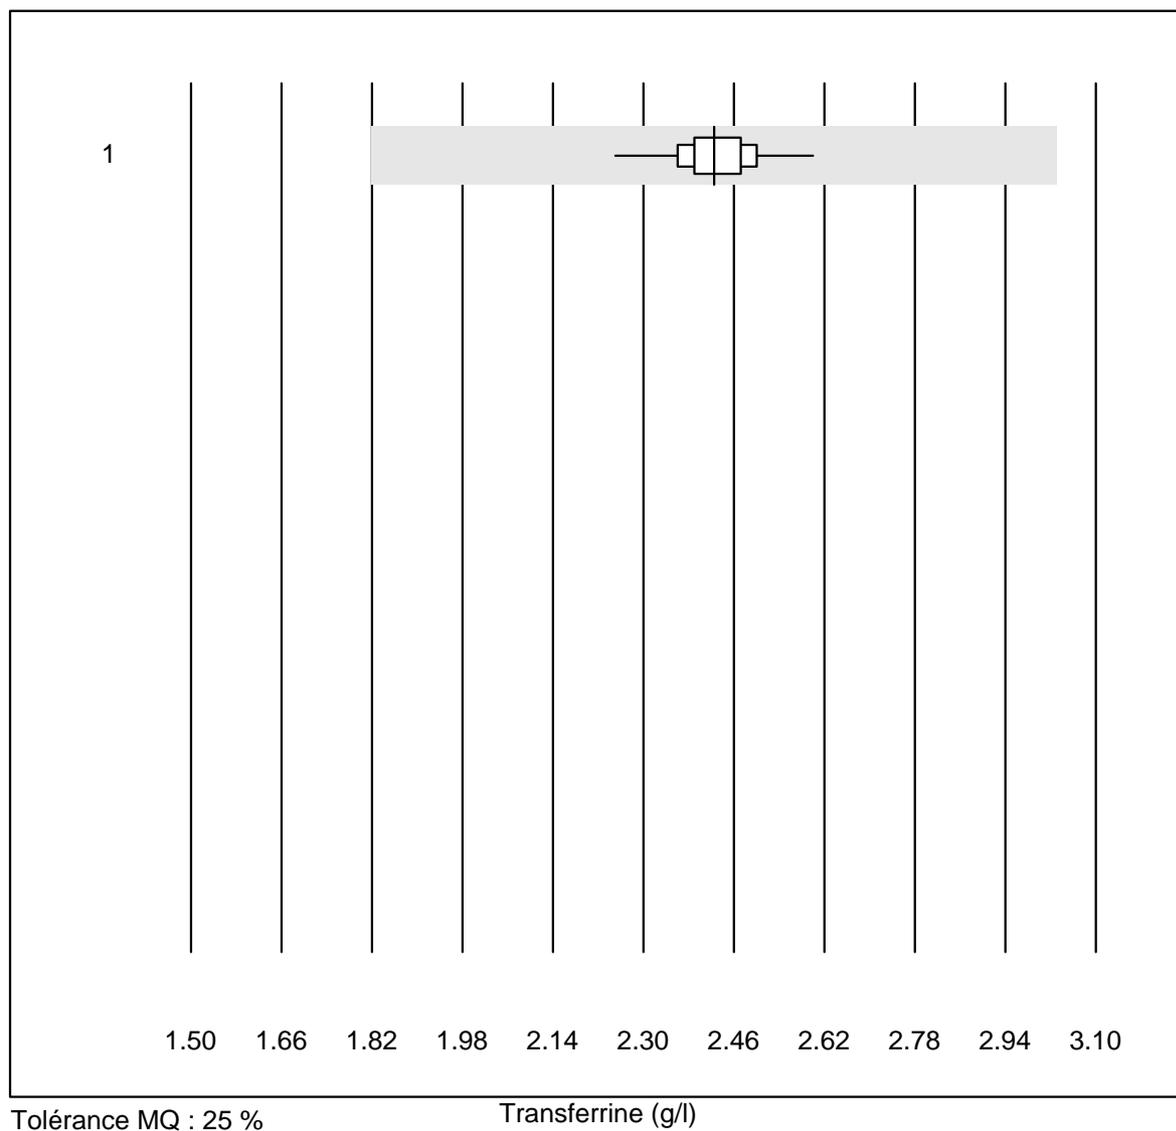

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	23	100.0	0.0	0.0	2.43	3.2	e

Beta-2-Mikroglobulin

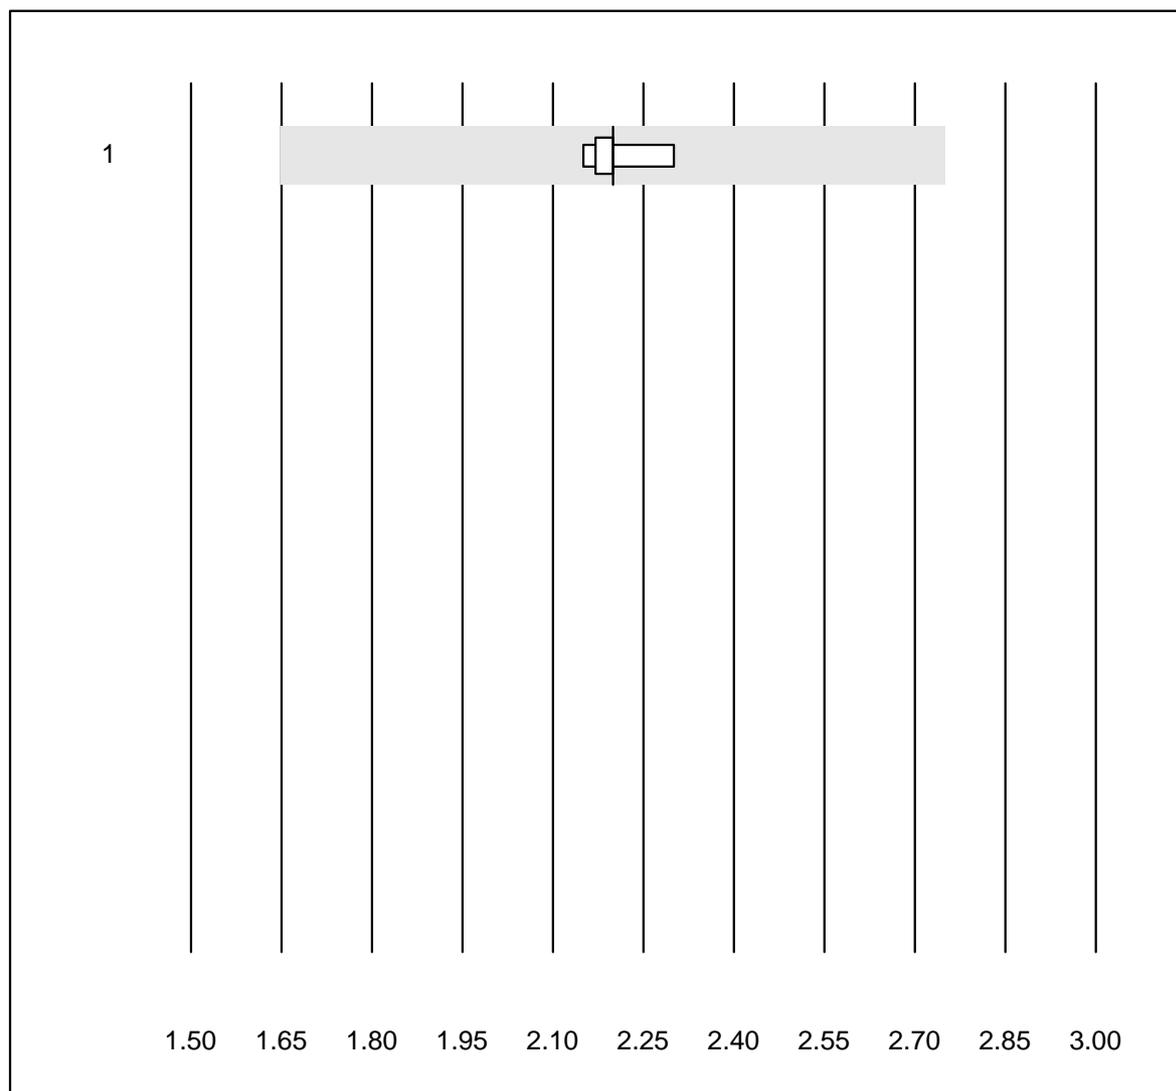


Tolérance MQ : 25 %

Beta-2-Mikroglobulin (mg/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	2.20	2.6	e

Facteur rhumatoïde

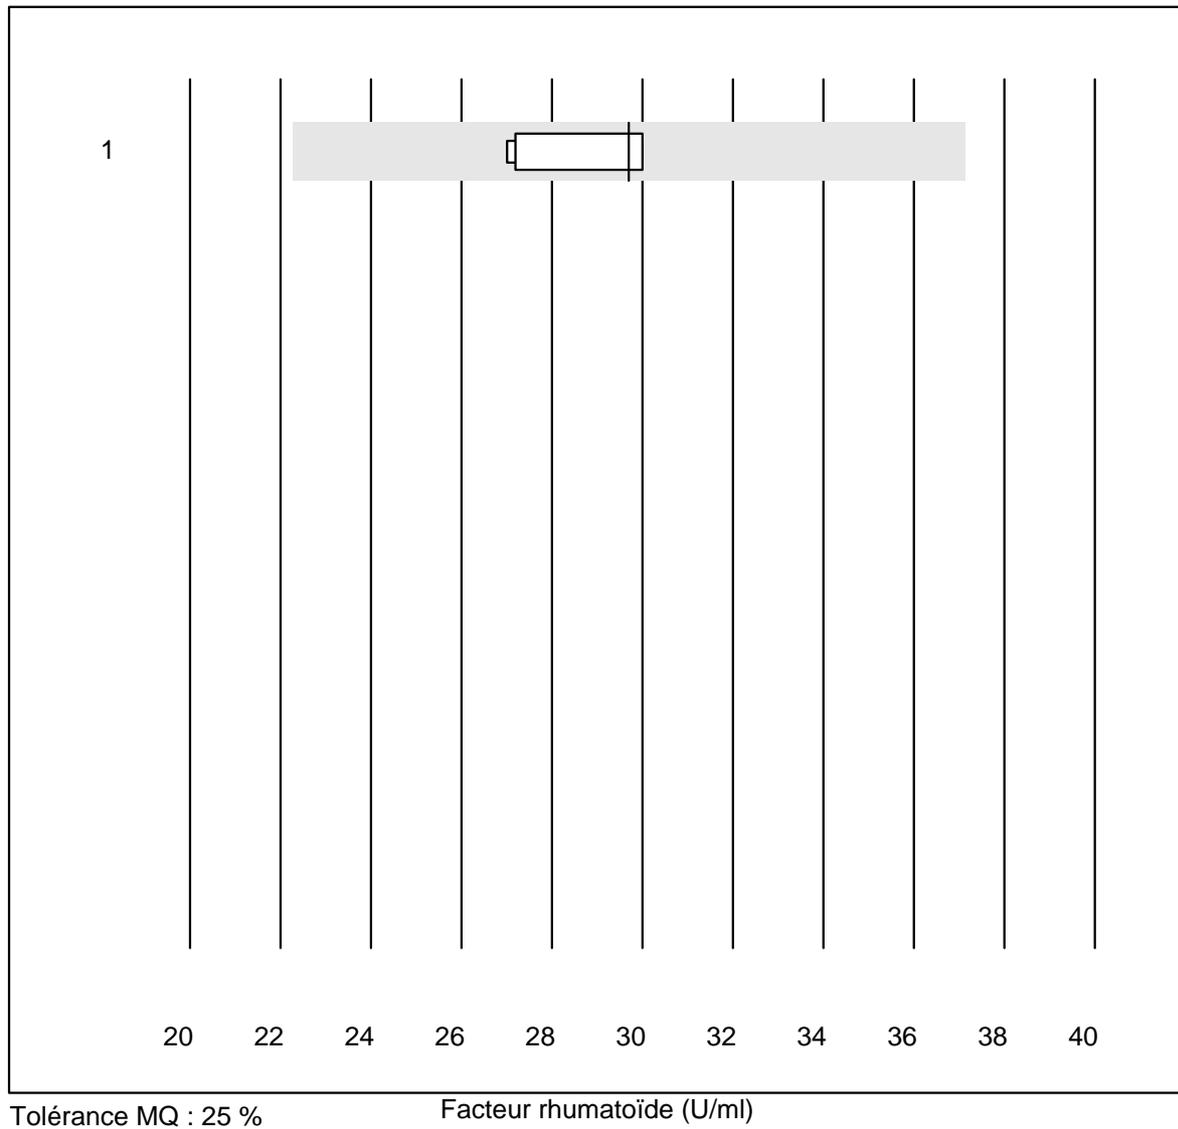


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	29.7	5.4	e

Ceruloplasmin

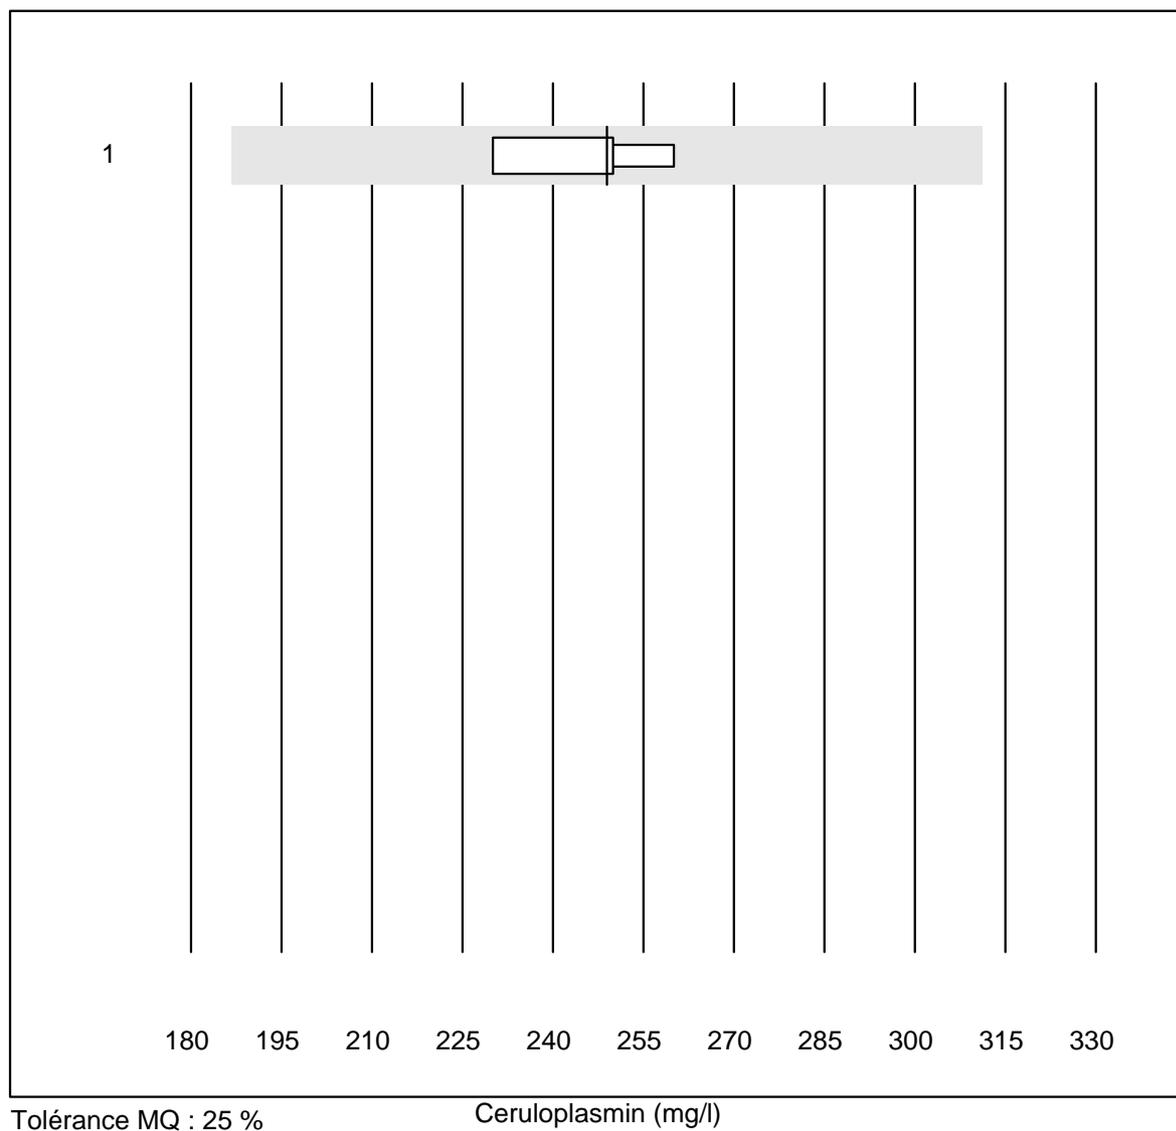


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	249.00	5.1	e

Präalbumin

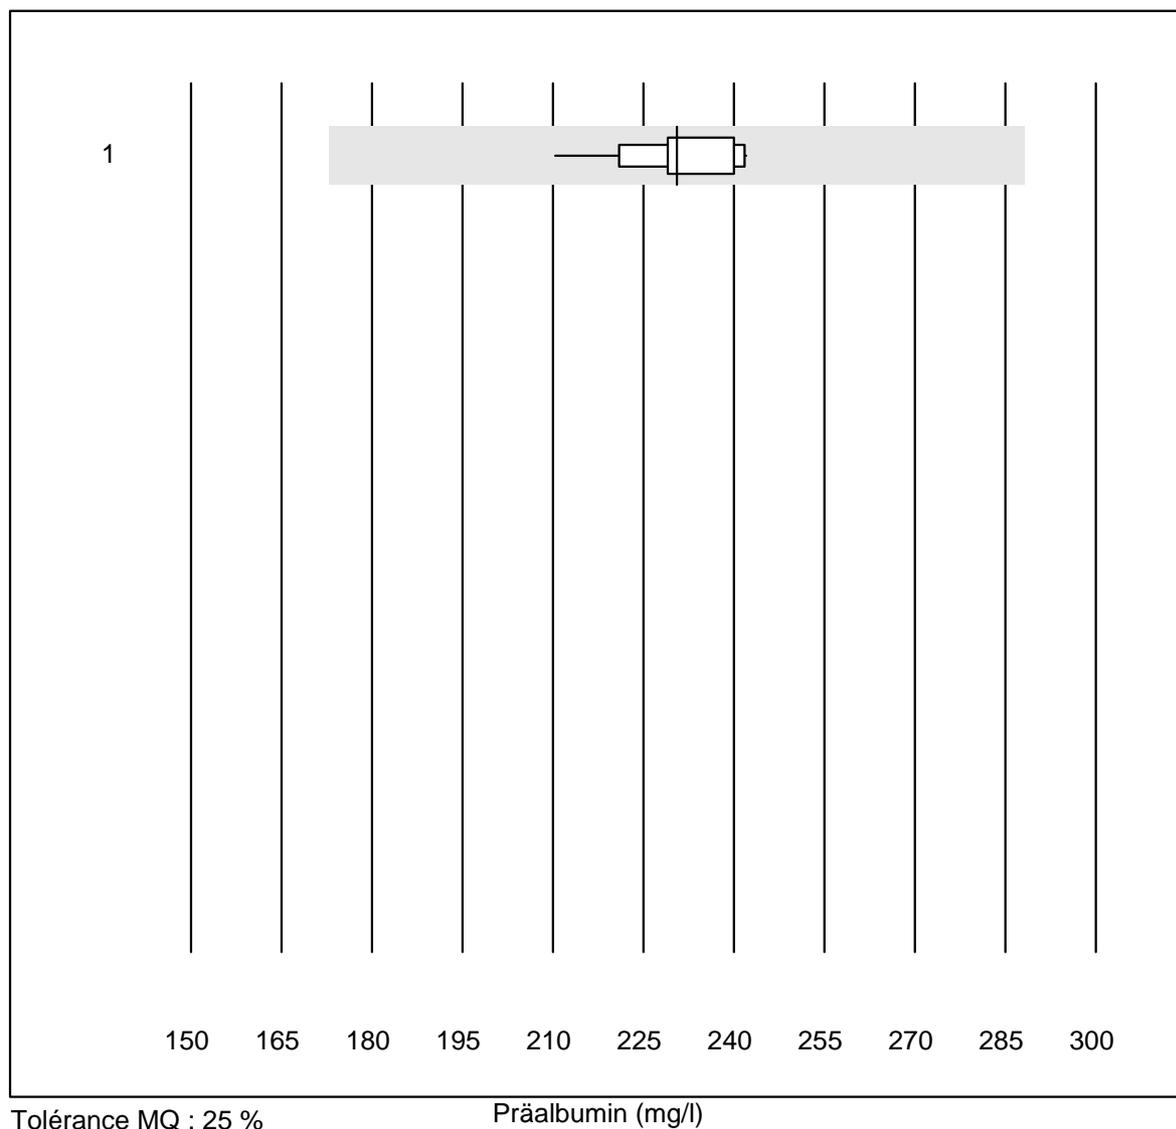

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	14	100.0	0.0	0.0	230.6	3.8	e

Récepteur soluble de la transferrine

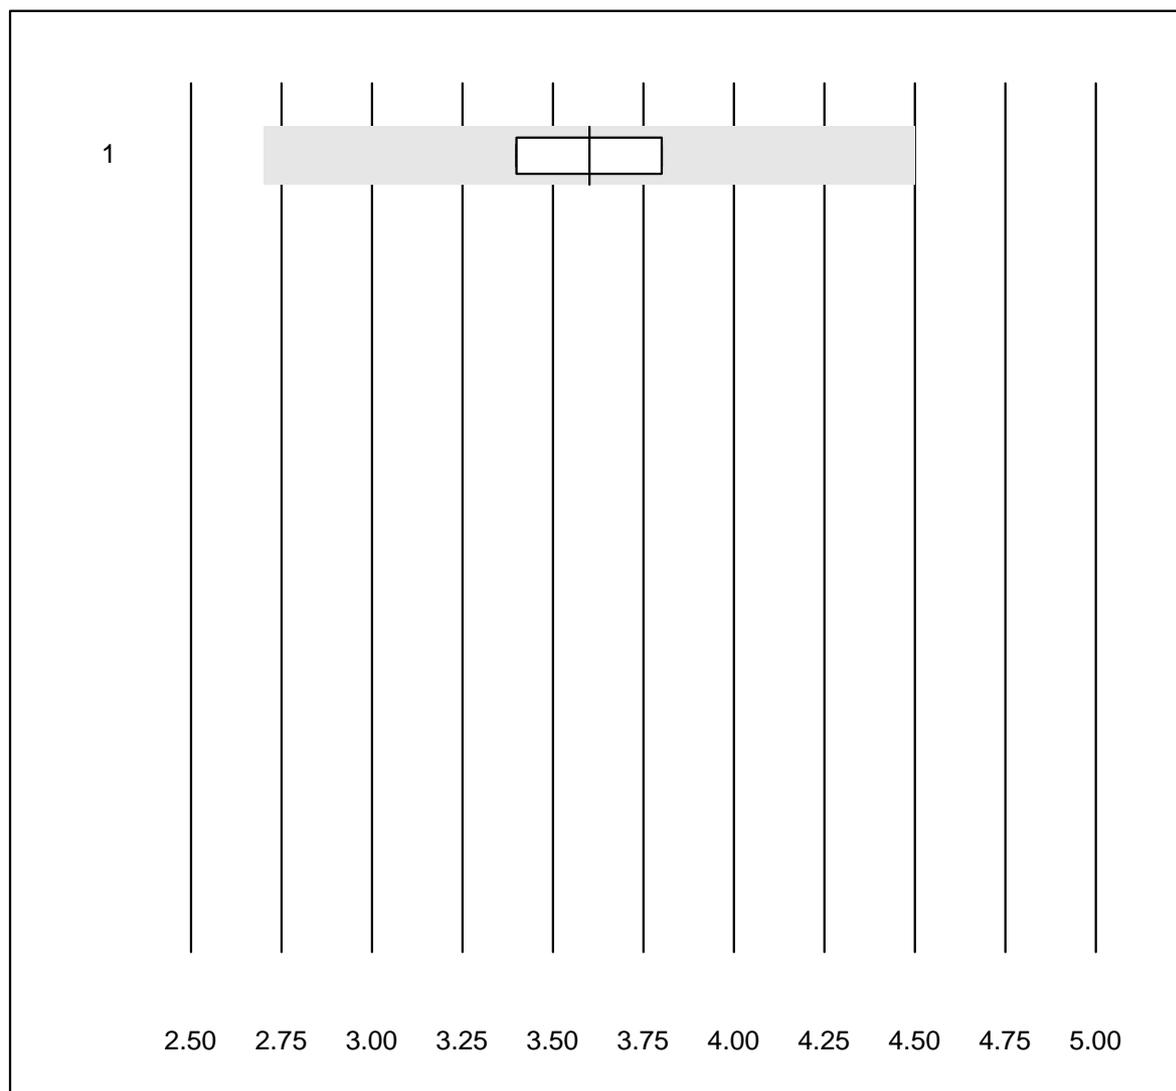


Tolérance MQ : 25 %

Récepteur soluble de la transferrine (mg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	3.6	6.4	e*

CRP HS

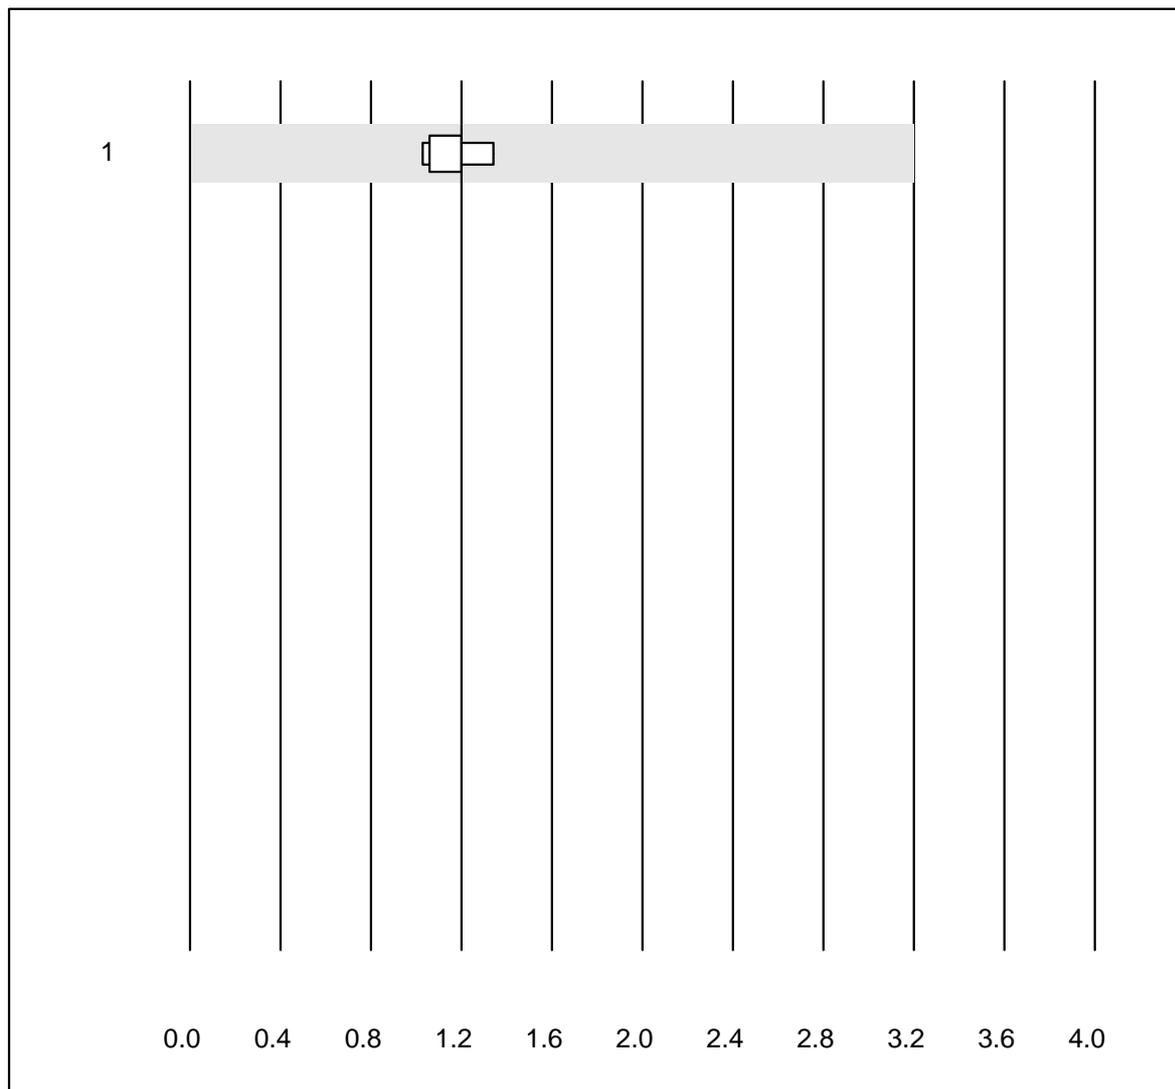


QUALAB Toleranz : 21 %
 (< 10.00: +/- 2.00 mg/l)

CRP HS (mg/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Turbidimetrie	5	100.0	0.0	0.0	1.20	10.7	e*

Lipoprotein (a)

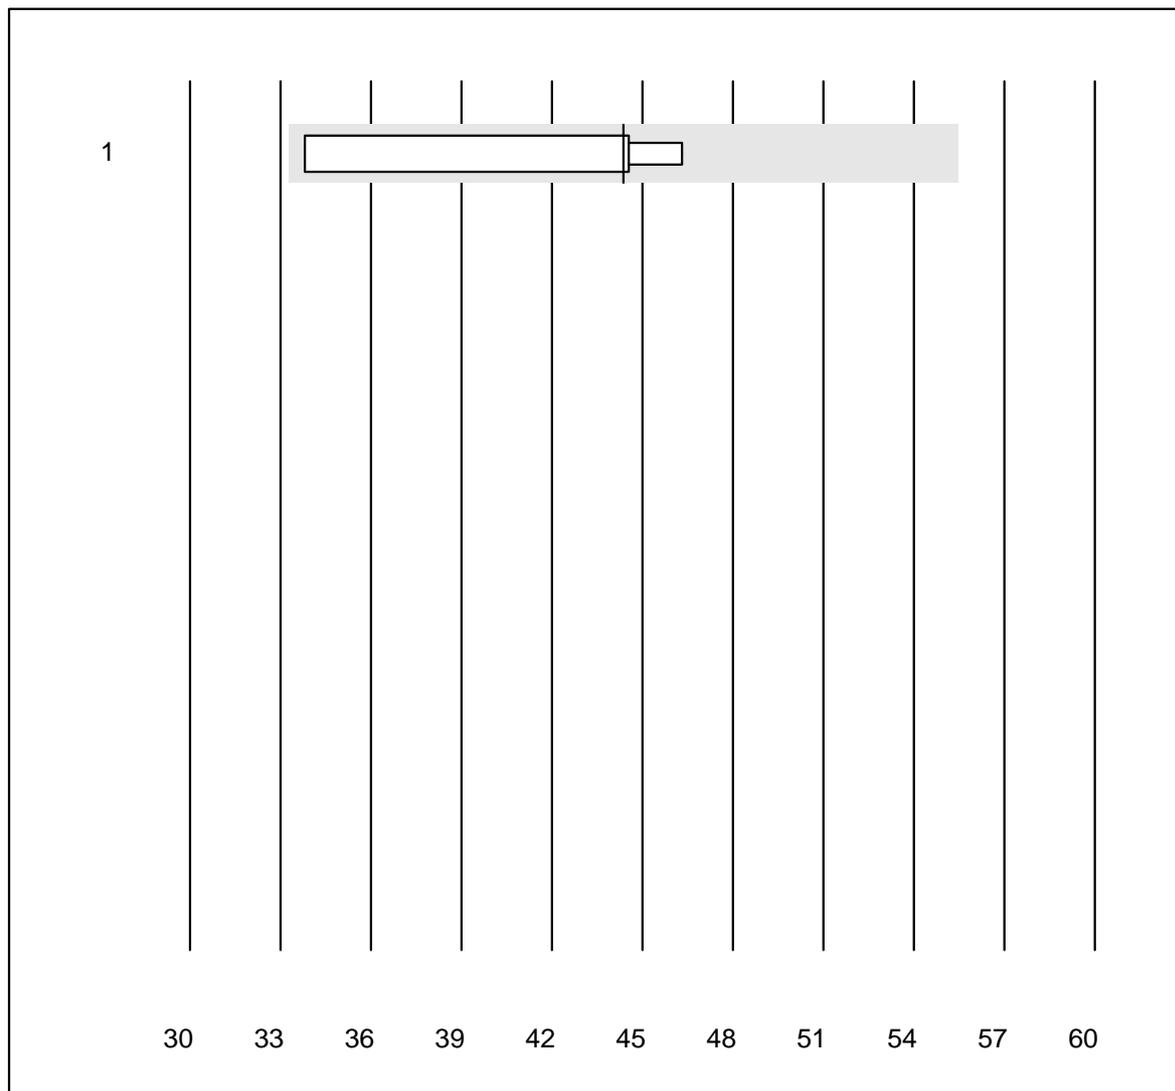


Tolérance MQ : 25 %

Lipoprotein (a) (nmol/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Andere	4	100.0	0.0	0.0	44	13.5	e*

CRP

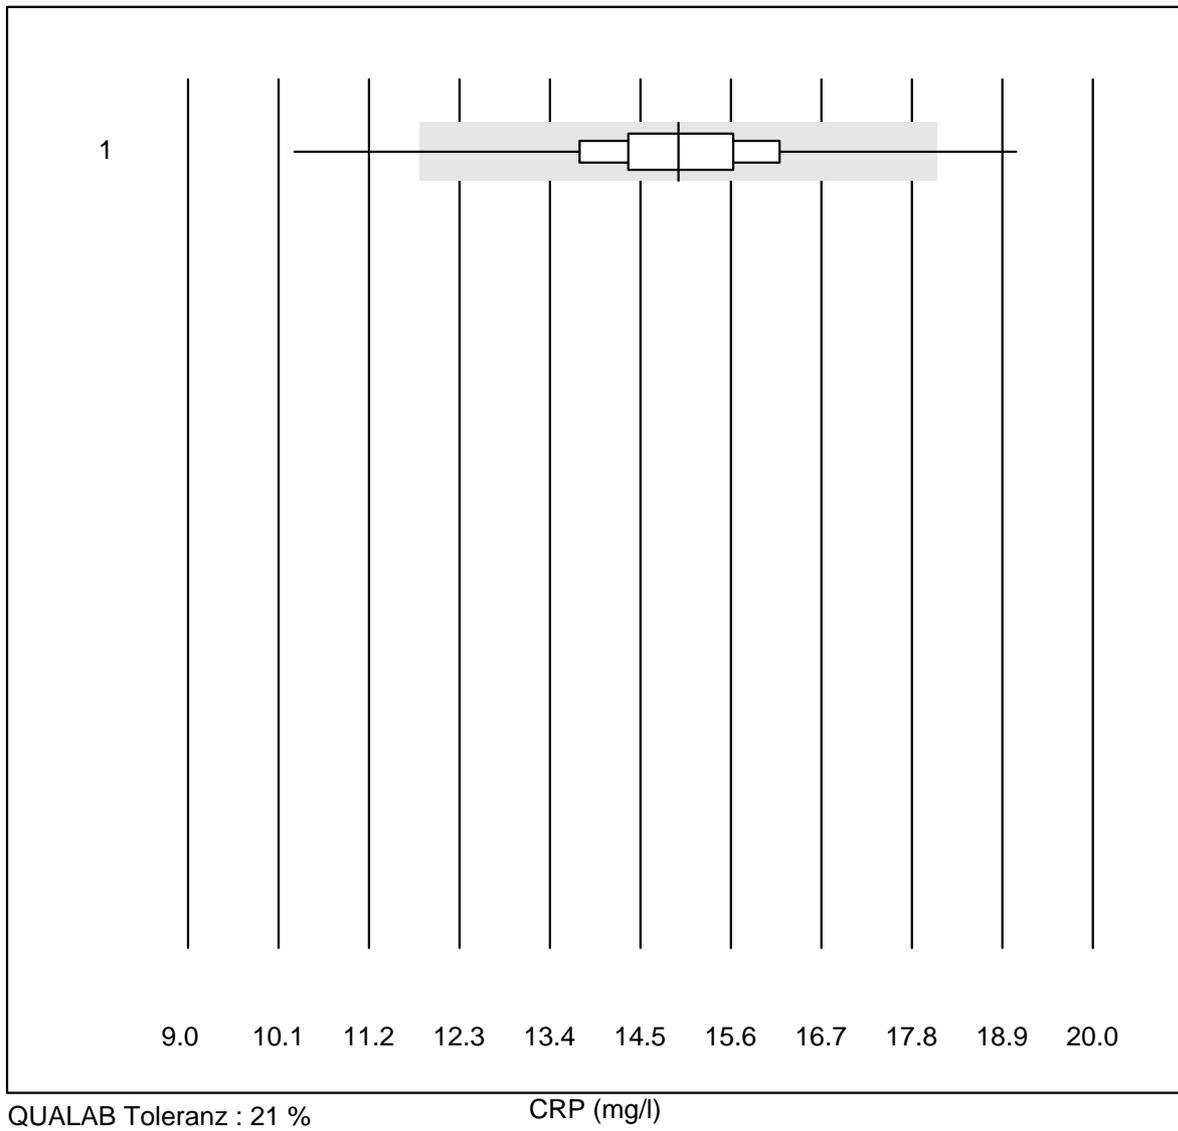

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 AFIAS	115	92.2	4.3	3.5	15.0	8.8	e

Albumine

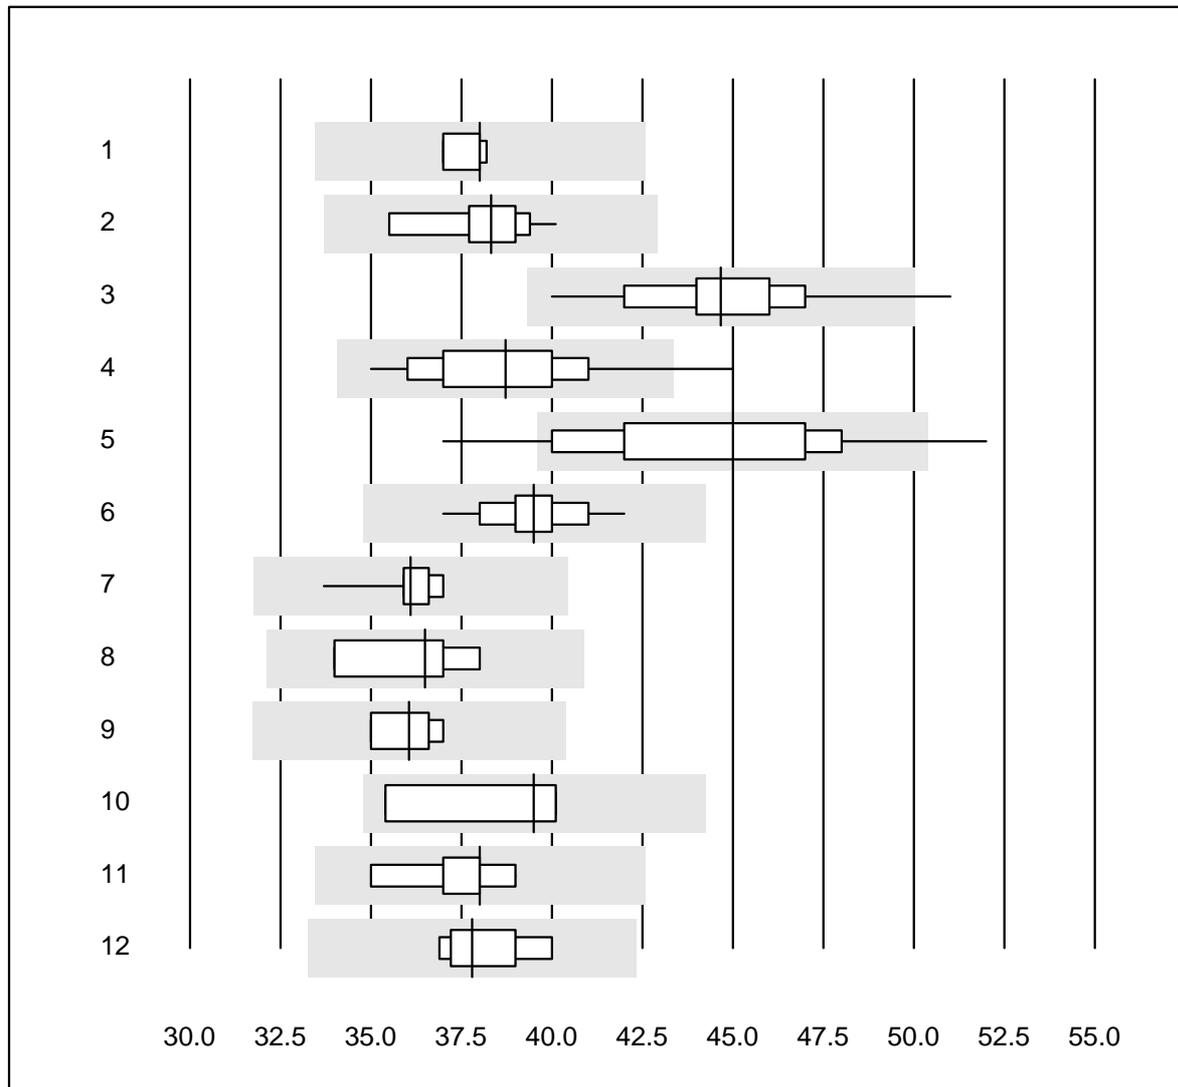


QUALAB Toleranz : 12 %

Albumine (g/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	8	100.0	0.0	0.0	38	1.3	e
2	Cobas	19	100.0	0.0	0.0	38	3.2	e
3	Fuji Dri-Chem	226	98.7	0.9	0.4	45	4.1	e
4	Spotchem/Ready	32	87.4	6.3	6.3	39	6.0	e
5	Spotchem D-Concept	152	89.4	9.9	0.7	45	7.1	e
6	Piccolo	52	96.2	0.0	3.8	40	2.7	e
7	Beckmann	13	100.0	0.0	0.0	36	2.3	e
8	Skyla	4	100.0	0.0	0.0	37	4.7	e*
9	Dimension	4	100.0	0.0	0.0	36	2.6	e
10	Abx Mira	4	100.0	0.0	0.0	40	5.8	e*
11	Hitachi S40/M40	9	100.0	0.0	0.0	38	3.3	e
12	Autolyser/DiaSys	7	100.0	0.0	0.0	38	2.9	e

Phosphatase alcaline

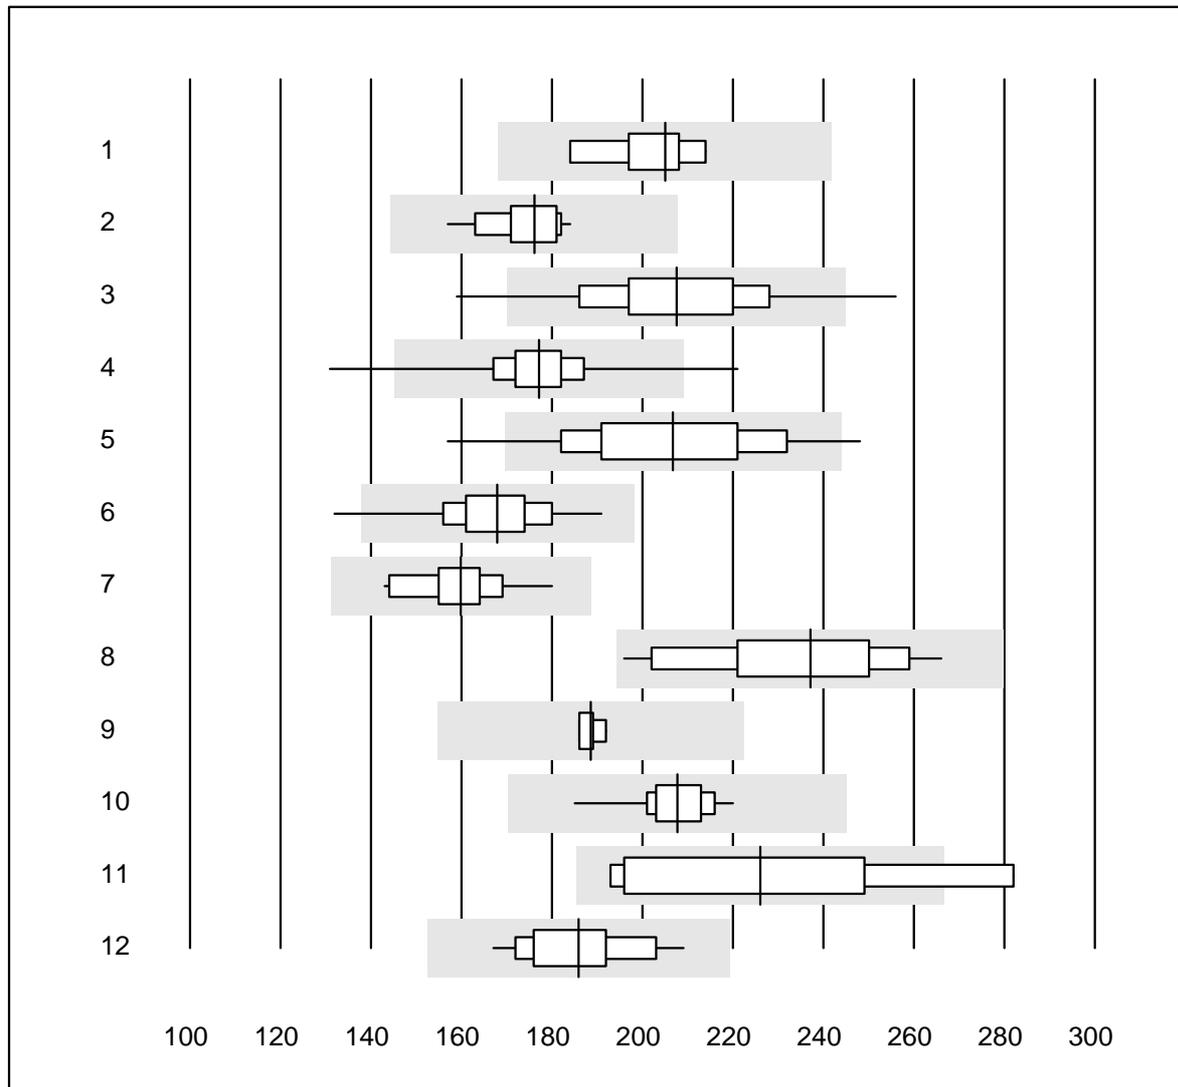


QUALAB Toleranz : 18 %

Phosphatase alcaline (U/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	7	100.0	0.0	0.0	205	4.7	e
2 Cobas	20	100.0	0.0	0.0	176	4.0	e
3 Reflotron	510	95.5	3.7	0.8	208	8.1	e
4 Fuji Dri-Chem	789	99.3	0.3	0.4	177	4.8	e
5 Spotchem/Ready	63	93.6	4.8	1.6	207	10.0	e
6 Spotchem D-Concept	279	98.9	0.4	0.7	168	5.7	e
7 Hitachi S40/M40	14	100.0	0.0	0.0	160	6.0	e
8 Beckman	16	100.0	0.0	0.0	237	8.6	e
9 Dimension	4	100.0	0.0	0.0	189	1.3	e
10 Piccolo	46	97.8	0.0	2.2	208	3.5	e
11 Abx Mira	7	85.7	14.3	0.0	226	14.3	e*
12 Autolyser/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	186	6.2	e

Amylase

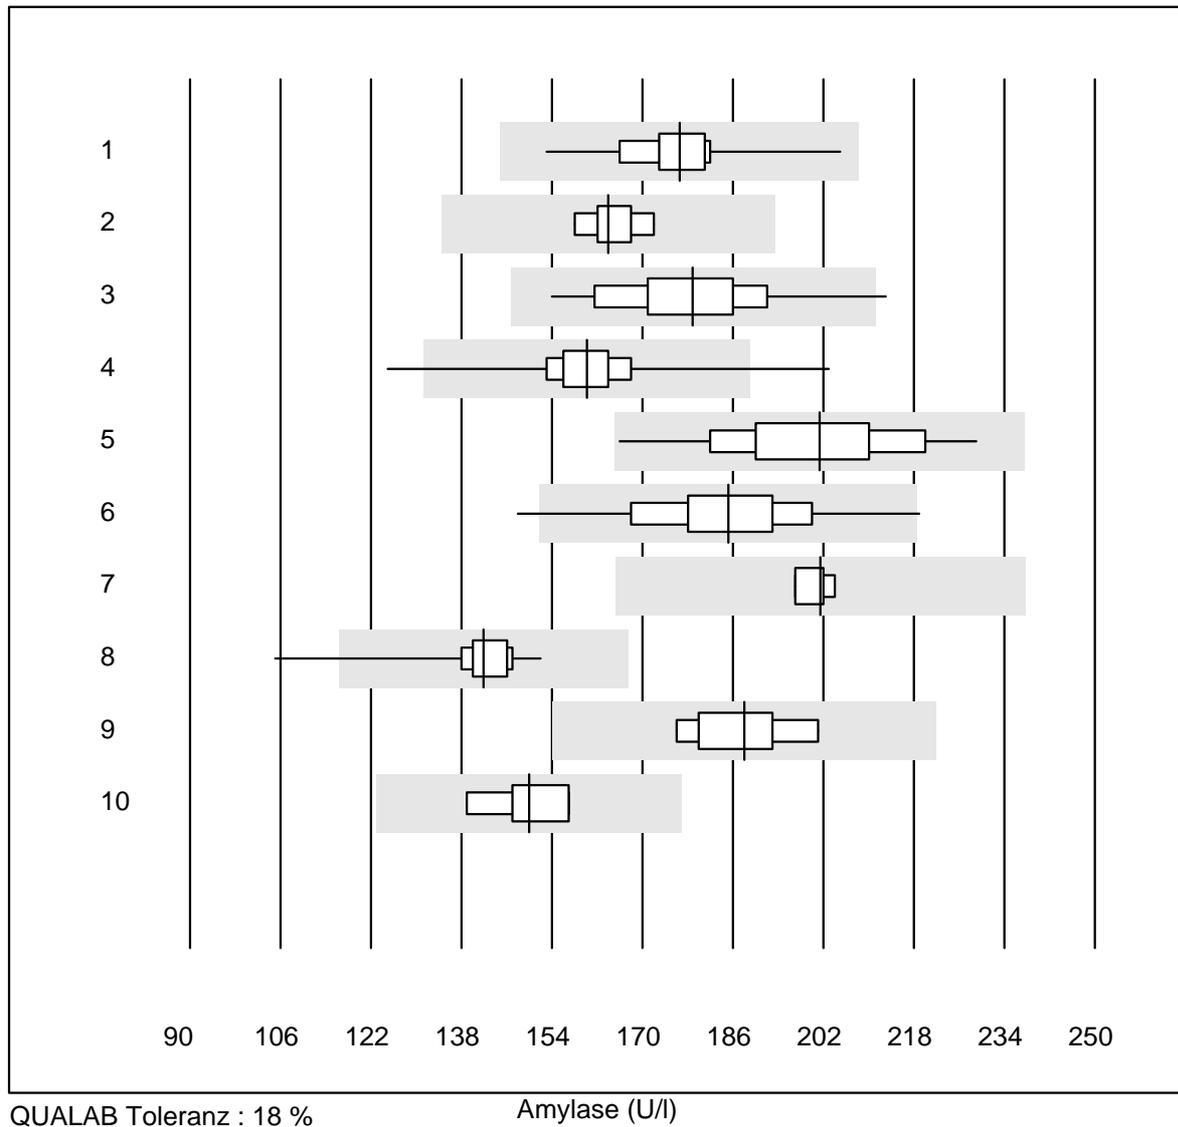


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	11	100.0	0.0	0.0	177	7.0	e
2 Cobas	6	100.0	0.0	0.0	164	2.9	e
3 Reflotron	132	96.9	0.8	2.3	179	6.6	e
4 Fuji Dri-Chem	577	99.0	0.7	0.3	160	4.1	e
5 Spotchem/Ready	42	100.0	0.0	0.0	201	7.6	e
6 Spotchem D-Concept	216	98.6	0.9	0.5	185	6.6	e
7 Architect	4	100.0	0.0	0.0	202	1.5	e
8 Piccolo	43	97.7	2.3	0.0	142	4.8	e
9 Hitachi S40/M40	7	100.0	0.0	0.0	188	4.4	e
10 Autolyser/DiaSys	7	100.0	0.0	0.0	150	4.4	e

Amylase pancréatique

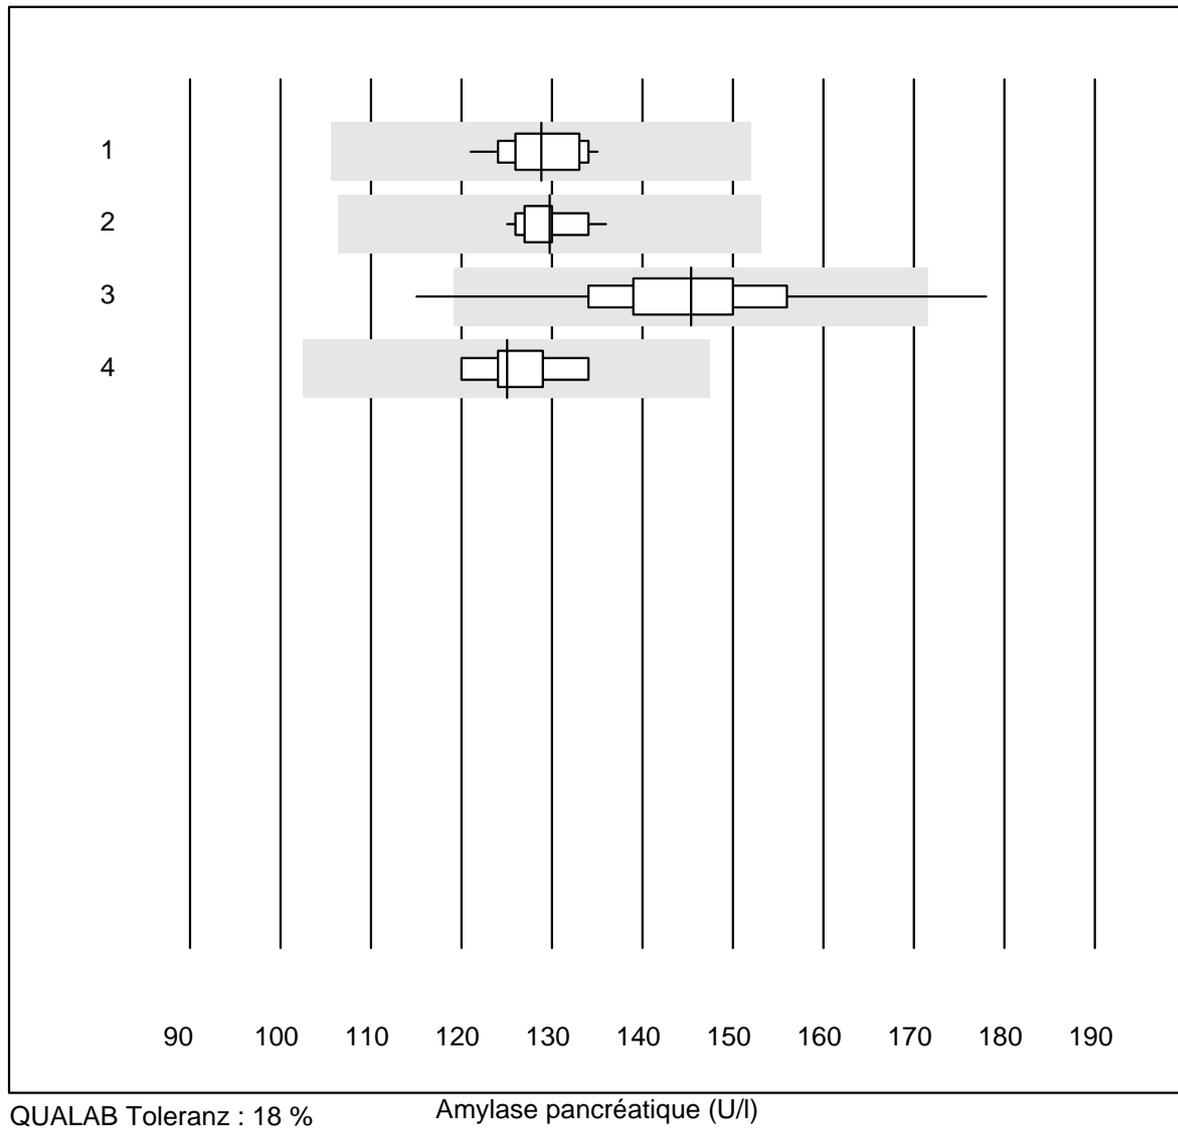

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	18	100.0	0.0	0.0	129	3.0	e
2 Cobas	12	100.0	0.0	0.0	130	2.5	e
3 Reflotron	341	95.6	2.9	1.5	145	6.7	e
4 Autolyser/DiaSys	9	100.0	0.0	0.0	125	3.4	e

Bilirubine totale

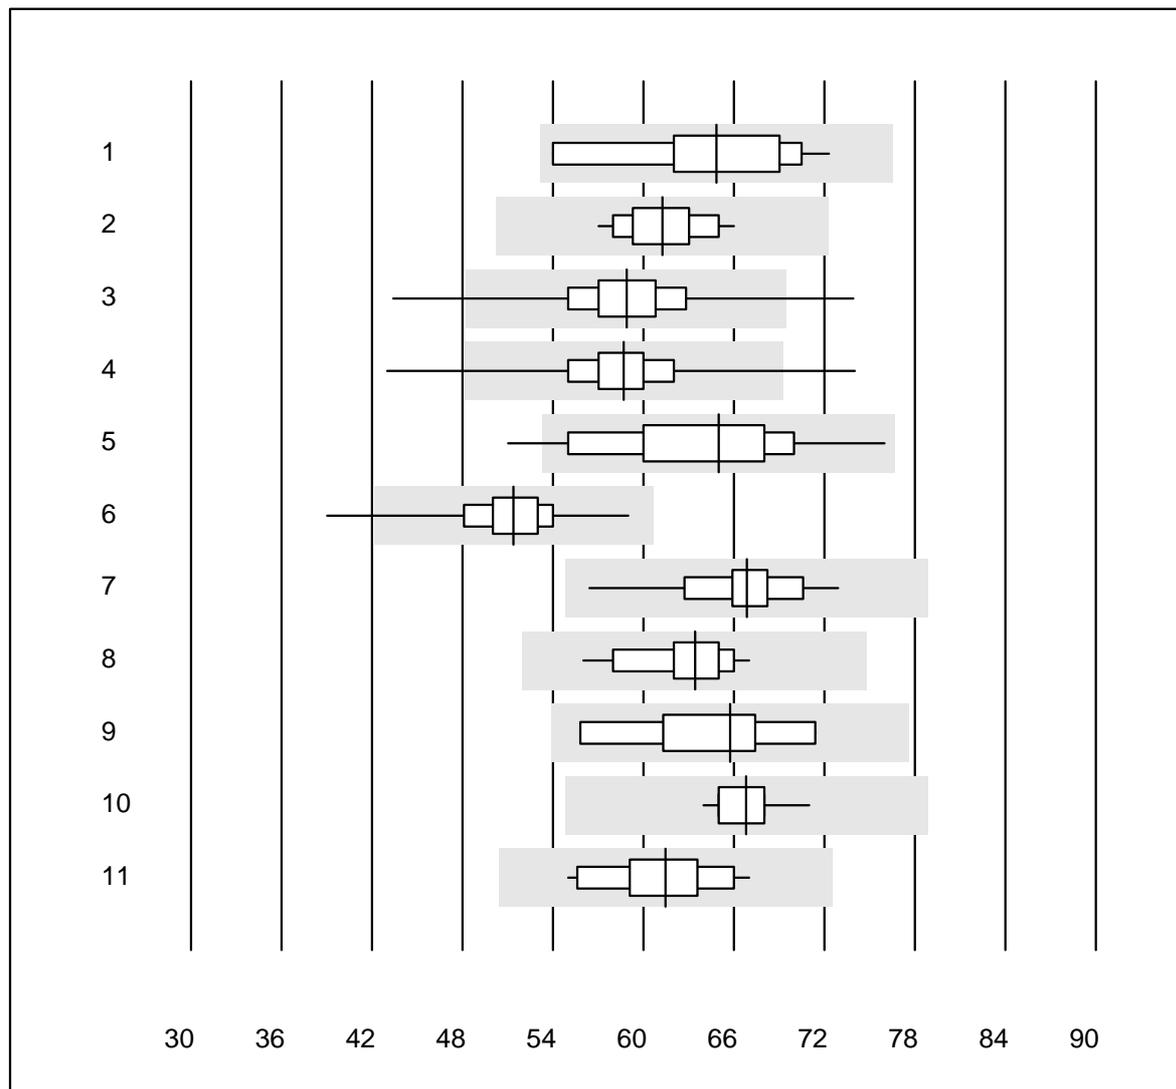


QUALAB Toleranz : 18 %

Bilirubine totale (µmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	10	100.0	0.0	0.0	64.8	8.1	e*
2	Cobas	18	100.0	0.0	0.0	61.2	4.0	e
3	Reflotron	380	95.8	1.8	2.4	58.9	6.0	e
4	Fuji Dri-Chem	628	98.4	0.6	1.0	58.7	4.8	e
5	Spotchem/Ready	57	92.9	5.3	1.8	65.0	8.8	e
6	Spotchem D-Concept	222	96.4	0.9	2.7	51.4	5.0	e
7	Beckman	12	100.0	0.0	0.0	66.8	6.2	e
8	Piccolo	50	96.0	0.0	4.0	63.4	4.3	e
9	Abx Mira	8	100.0	0.0	0.0	65.8	7.5	e*
10	Hitachi S40/M40	11	100.0	0.0	0.0	66.8	2.9	e
11	Autolyser/DiaSys	16	100.0	0.0	0.0	61.5	5.7	e

Bilirubine directe

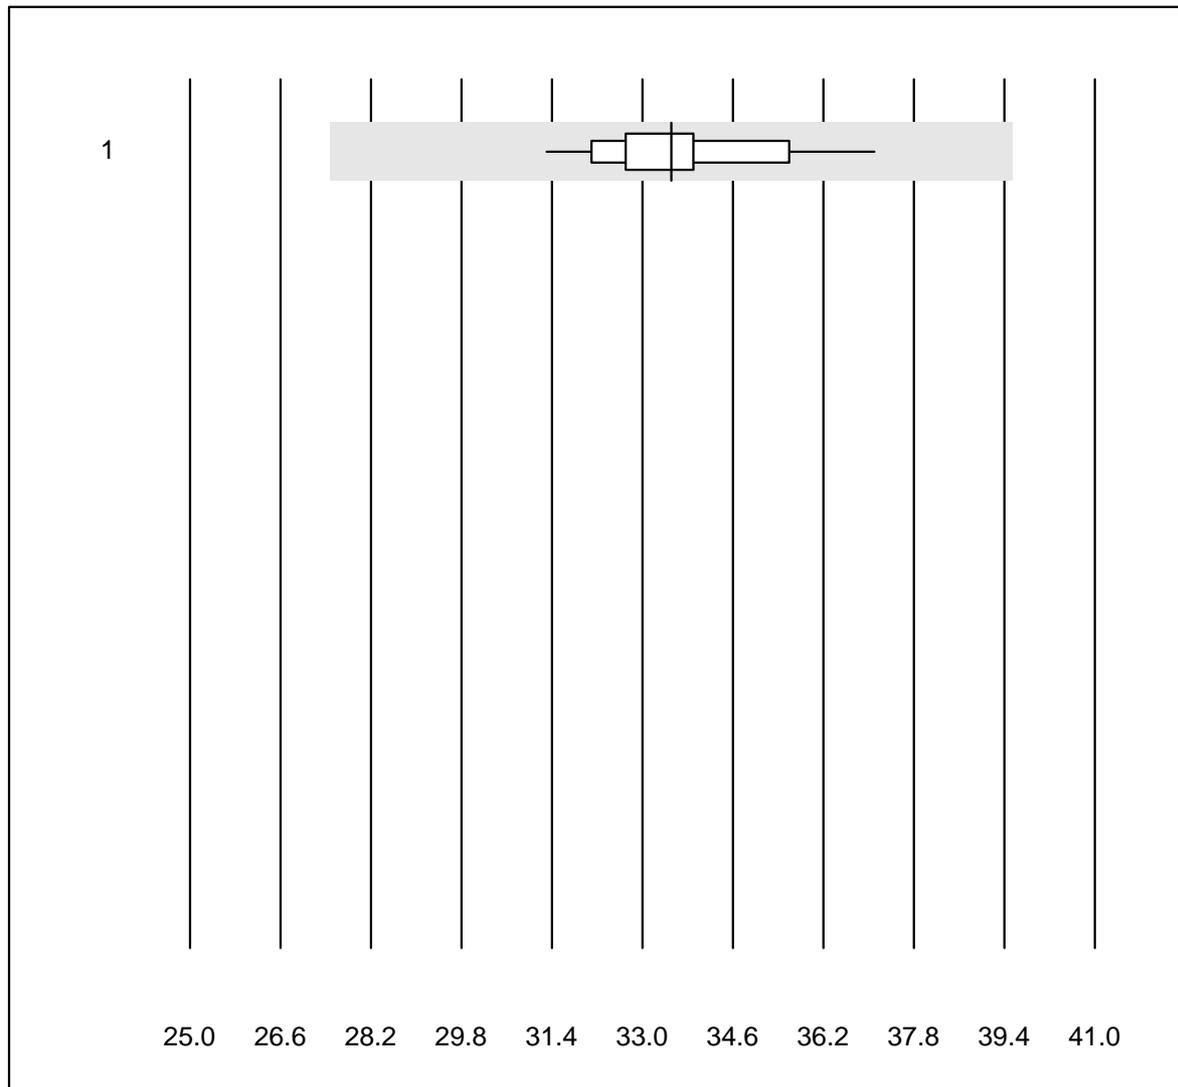


Tolérance MQ : 18 %

Bilirubine directe (µmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Fuji Dri-Chem	28	96.4	0.0	3.6	33.5	4.0	e

Calcium

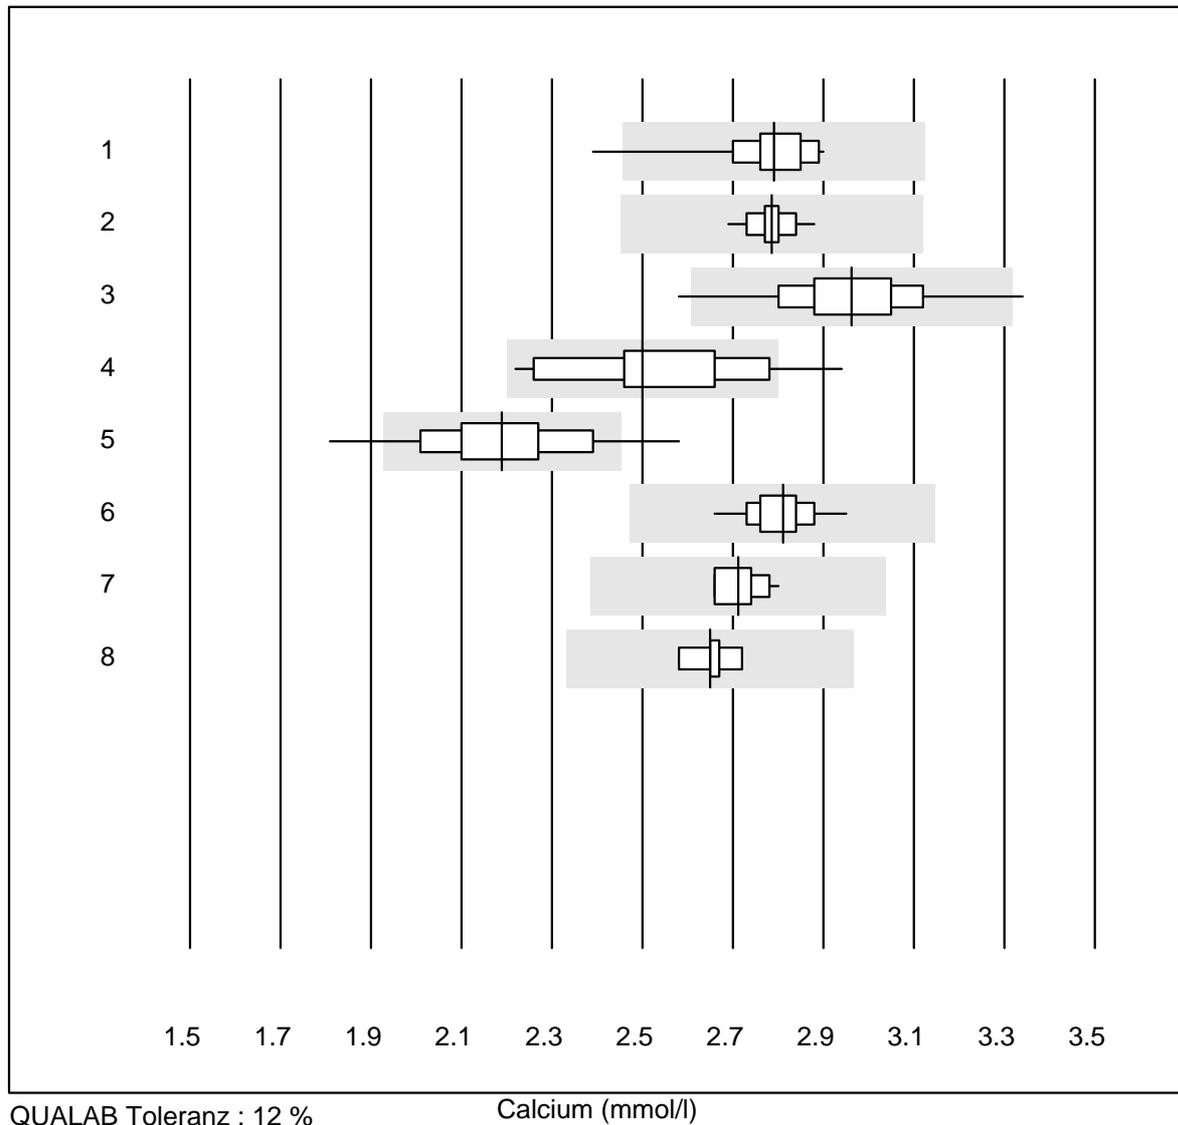


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	29	96.6	3.4	0.0	2.79	3.7	e
2	Cobas	20	100.0	0.0	0.0	2.79	1.5	e
3	Fuji Dri-Chem	367	98.4	0.5	1.1	2.96	4.2	e
4	Spotchem/Ready	19	94.7	5.3	0.0	2.50	6.9	e*
5	Spotchem D-Concept	98	96.9	3.1	0.0	2.19	6.6	e
6	Piccolo	49	98.0	0.0	2.0	2.81	2.1	e
7	Hitachi S40/M40	11	100.0	0.0	0.0	2.71	1.7	e
8	Autolyser/DiaSys	9	100.0	0.0	0.0	2.65	1.4	e

Calcium ISE

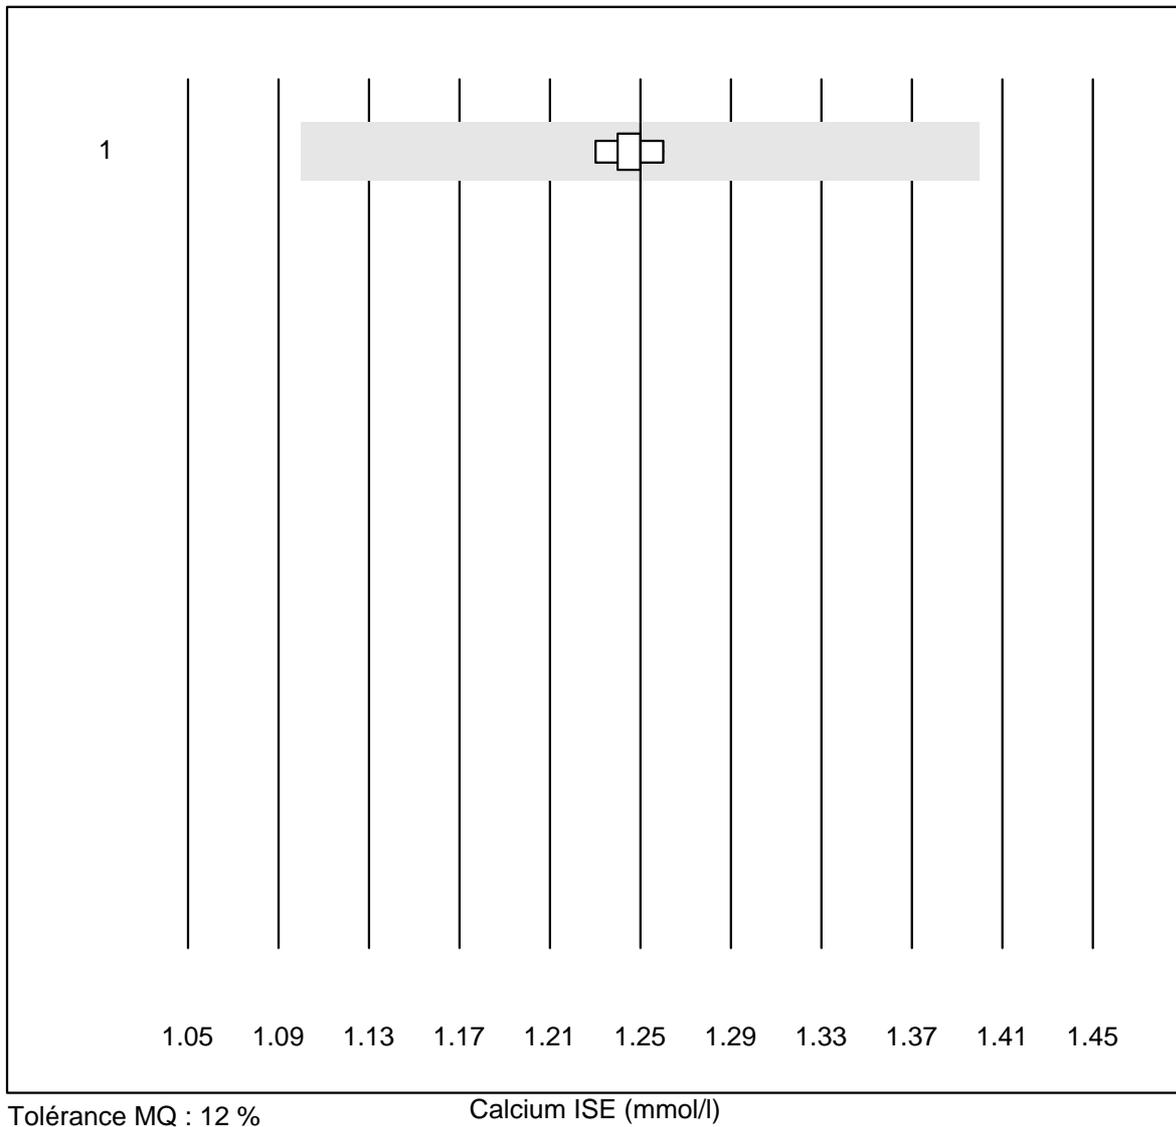


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	iStat Chem8	5	100.0	0.0	0.0	1.25	0.9	e

Chlorures

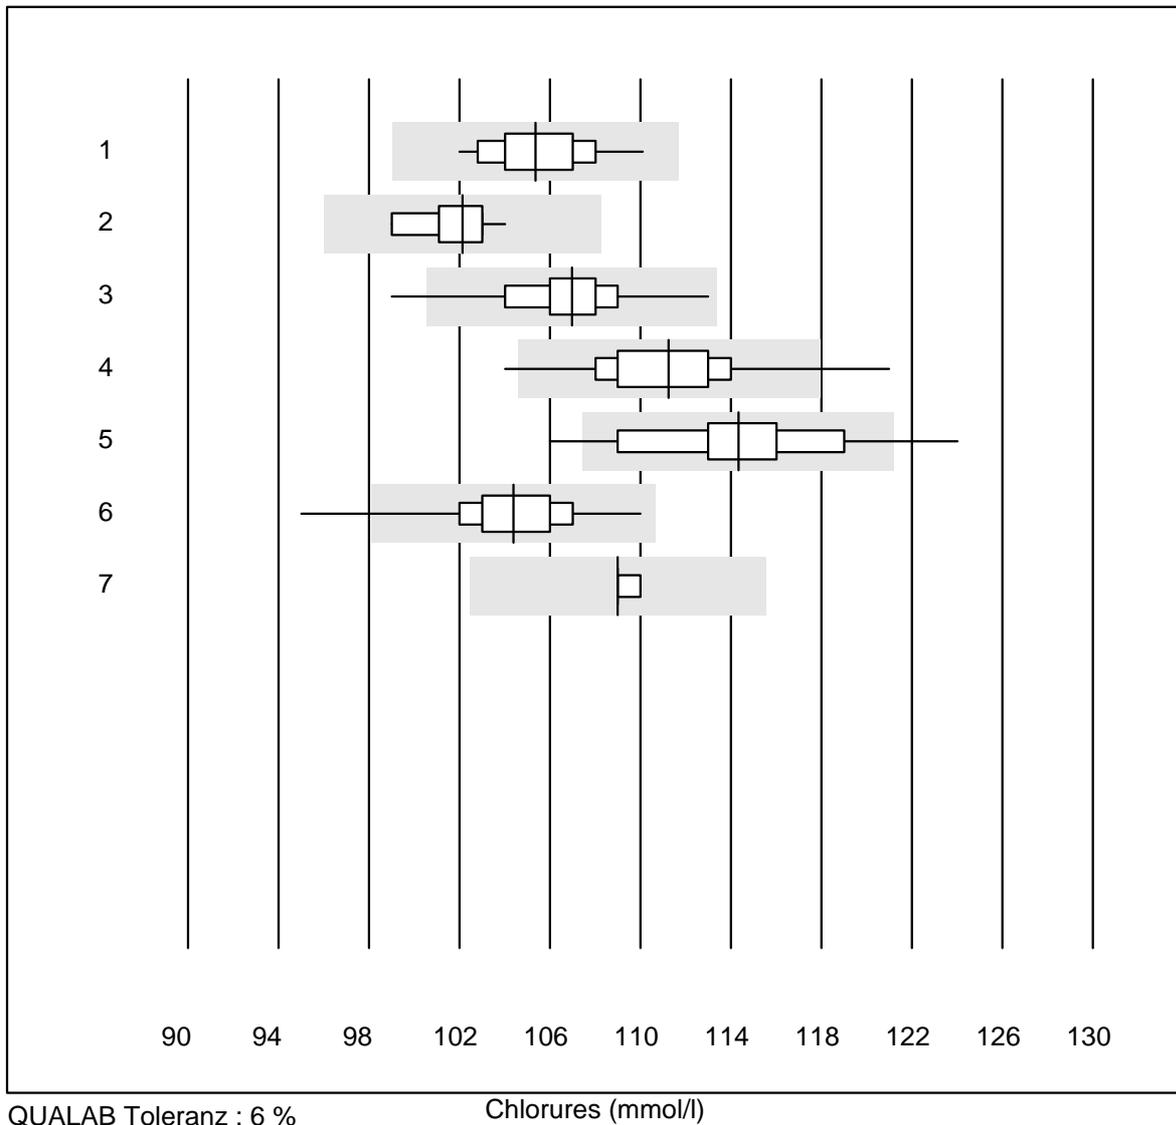

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 ISE	29	100.0	0.0	0.0	105	2.0	e
2 Cobas	10	100.0	0.0	0.0	102	1.4	e
3 Fuji Dri-Chem	731	98.8	0.8	0.4	107	2.0	e
4 Spotchem D-Concept	252	98.0	1.2	0.8	111	2.3	e
5 Spotchem EL-SE 1520	75	86.7	9.3	4.0	114	3.2	e
6 Piccolo	24	95.8	4.2	0.0	104	2.6	e
7 iStat Chem8	4	100.0	0.0	0.0	109	0.5	e

Cholestérol

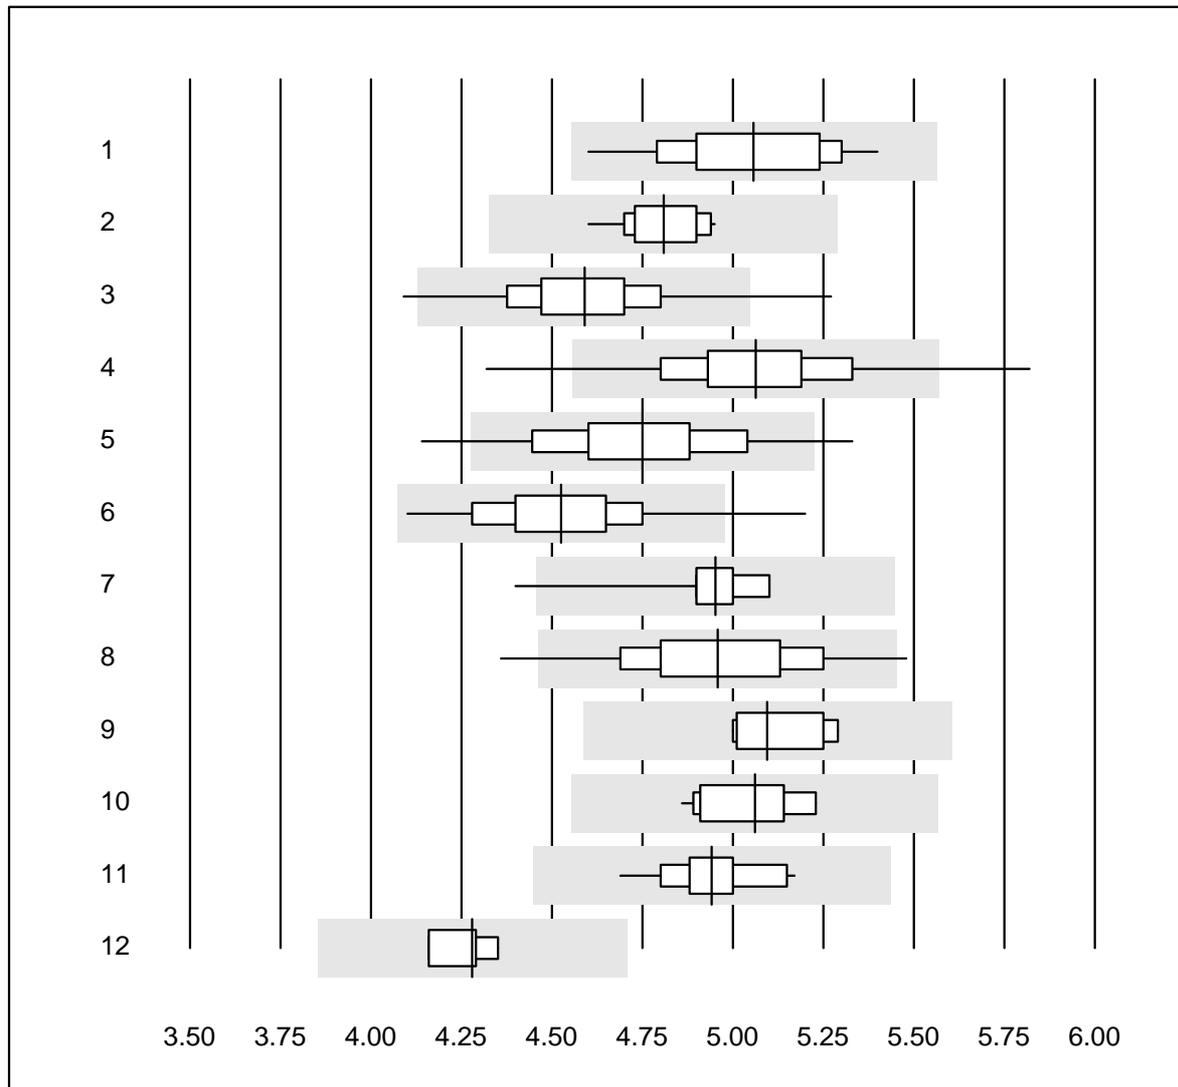


QUALAB Toleranz : 10 %

Cholestérol (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	28	96.4	0.0	3.6	5.06	4.3	e
2	Cobas	19	100.0	0.0	0.0	4.81	1.9	e
3	Reflotron	463	97.0	2.4	0.6	4.59	3.9	e
4	Fuji Dri-Chem	782	97.4	1.3	1.3	5.06	4.1	e
5	Spotchem/Ready	81	93.8	6.2	0.0	4.75	5.3	e
6	Spotchem D-Concept	283	96.4	2.5	1.1	4.53	4.1	e
7	Piccolo	23	91.4	4.3	4.3	4.95	2.9	e
8	Cholestech LDX	110	96.4	3.6	0.0	4.96	4.4	e
9	Abx Mira	6	100.0	0.0	0.0	5.10	2.5	e
10	Hitachi S40/M40	11	100.0	0.0	0.0	5.06	2.7	e
11	Autolyser/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	4.94	2.6	e
12	Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	4.28	1.9	e

Cholestérol HDL

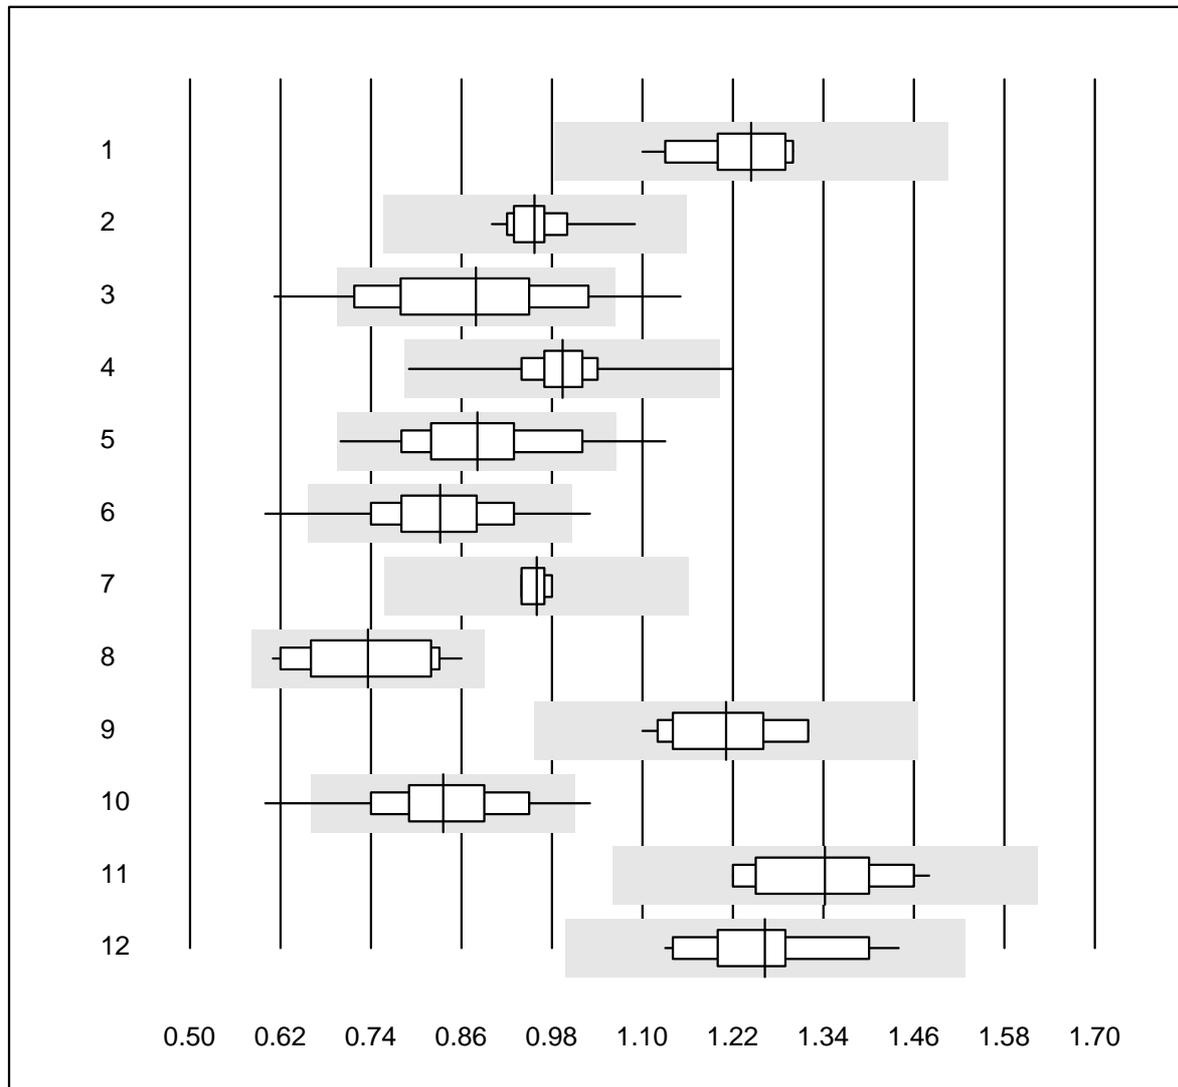


QUALAB Toleranz : 21 %

Cholestérol HDL (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	humide, direct	18	94.4	0.0	5.6	1.24	4.8	e
2	Cobas	18	100.0	0.0	0.0	0.96	4.3	e
3	Reflotron	334	77.8	11.4	10.8	0.88	13.6	e
4	Fuji Dri-Chem	753	98.8	0.1	1.1	0.99	4.3	e
5	Spotchem/Ready	71	97.2	1.4	1.4	0.88	9.9	e
6	Spotchem D-Concept	278	95.4	3.2	1.4	0.83	9.2	e
7	Dimension	4	100.0	0.0	0.0	0.96	1.9	e
8	Piccolo	21	100.0	0.0	0.0	0.74	11.4	e
9	Pentra/Selectra	12	100.0	0.0	0.0	1.21	6.1	e
10	Cholestech LDX	110	91.8	6.4	1.8	0.84	10.3	e
11	Hitachi S40/M40	11	90.9	0.0	9.1	1.34	6.8	e
12	Autolyser/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	1.26	7.1	e

Créatine-kinase

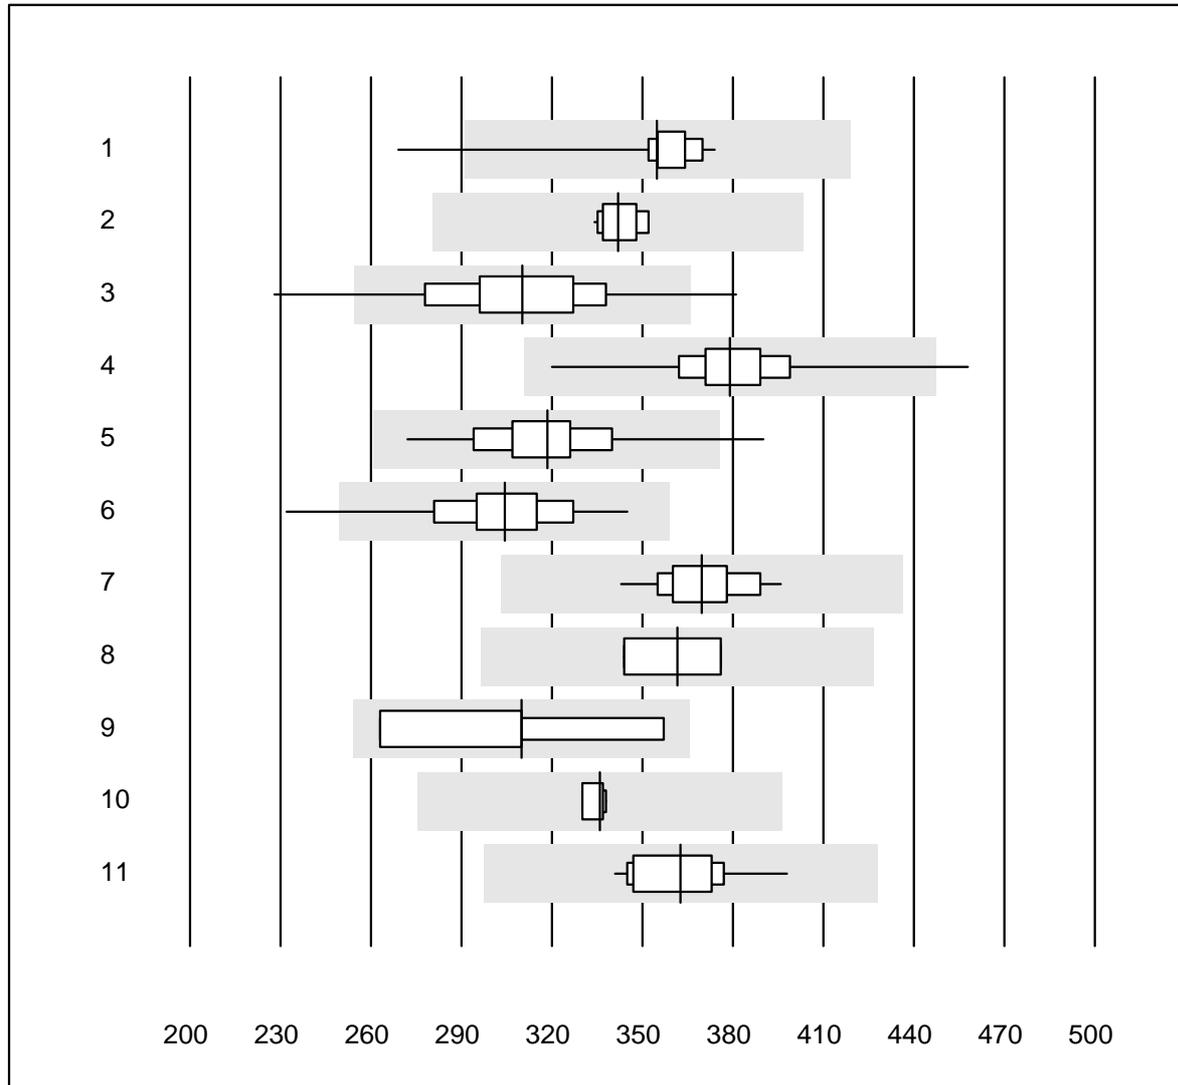


QUALAB Toleranz : 18 %

Créatine-kinase (U/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	24	95.8	4.2	0.0	355	6.2	e
2 Cobas	18	100.0	0.0	0.0	342	1.7	e
3 Reflotron	335	93.4	4.2	2.4	310	7.9	e
4 Fuji Dri-Chem	518	98.6	0.2	1.2	379	4.1	e
5 Spotchem/Ready	36	94.4	2.8	2.8	318	6.9	e
6 Spotchem D-Concept	171	98.2	0.6	1.2	304	5.9	e
7 Piccolo	17	100.0	0.0	0.0	370	3.9	e
8 Abx Mira	4	100.0	0.0	0.0	362	4.9	e*
9 Hitachi S40/M40	4	100.0	0.0	0.0	310	12.4	e*
10 Dimension	4	100.0	0.0	0.0	336	1.1	e
11 Autolyser/DiaSys	15	100.0	0.0	0.0	363	4.3	e

LDL Cholesterin

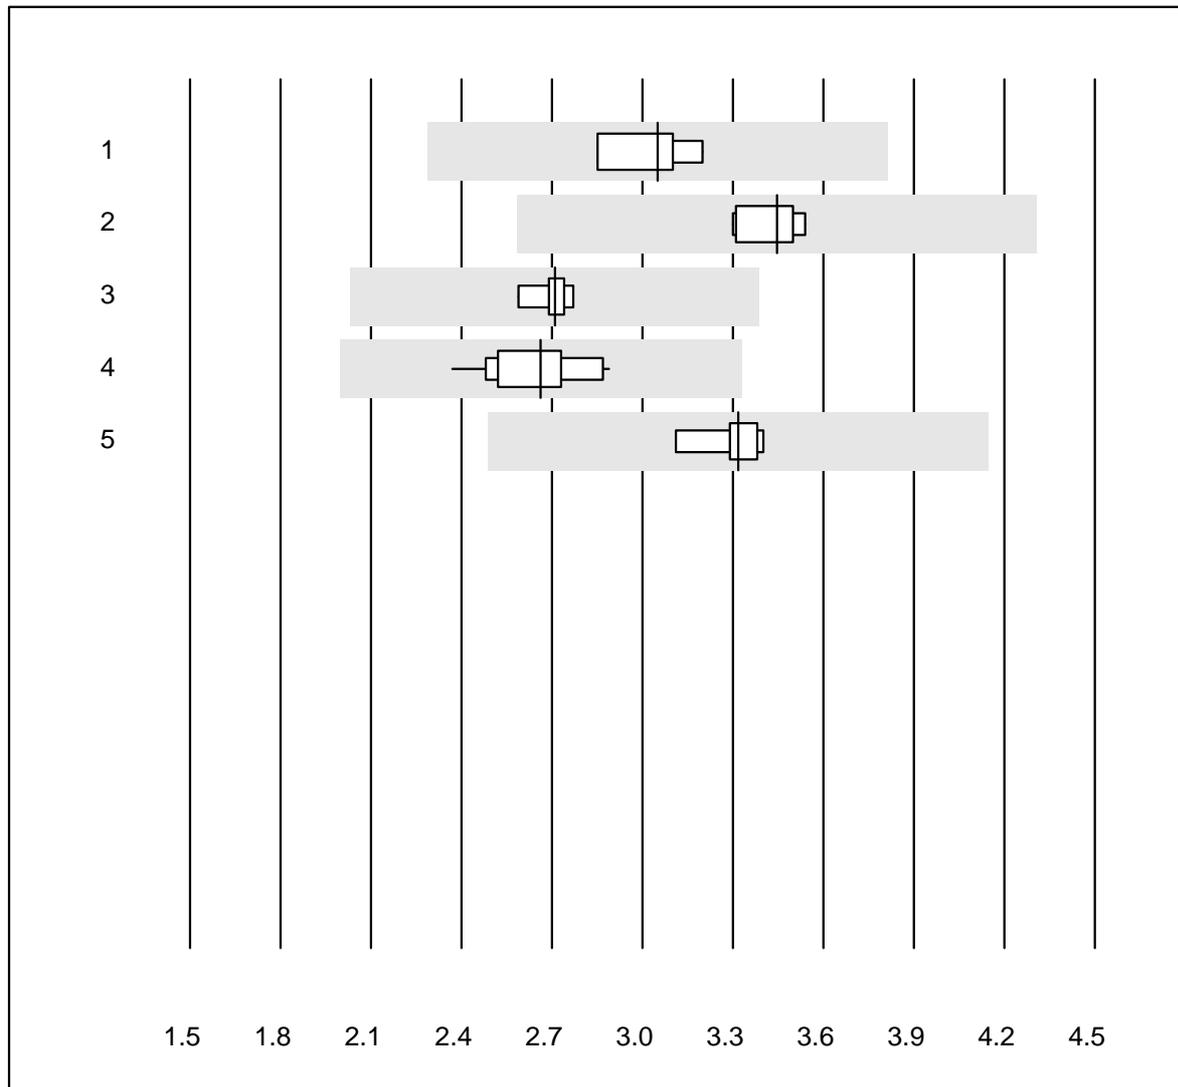


Tolérance MQ : 25 %

LDL Cholesterin (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	4	100.0	0.0	0.0	3.1	4.9	e
2	Roche, Cobas	8	100.0	0.0	0.0	3.4	2.6	e
3	Hitachi S40/M40	5	100.0	0.0	0.0	2.7	2.5	e
4	Autolyser/DiaSys	13	100.0	0.0	0.0	2.7	5.8	e
5	Beckman	10	100.0	0.0	0.0	3.3	2.7	e

Fer

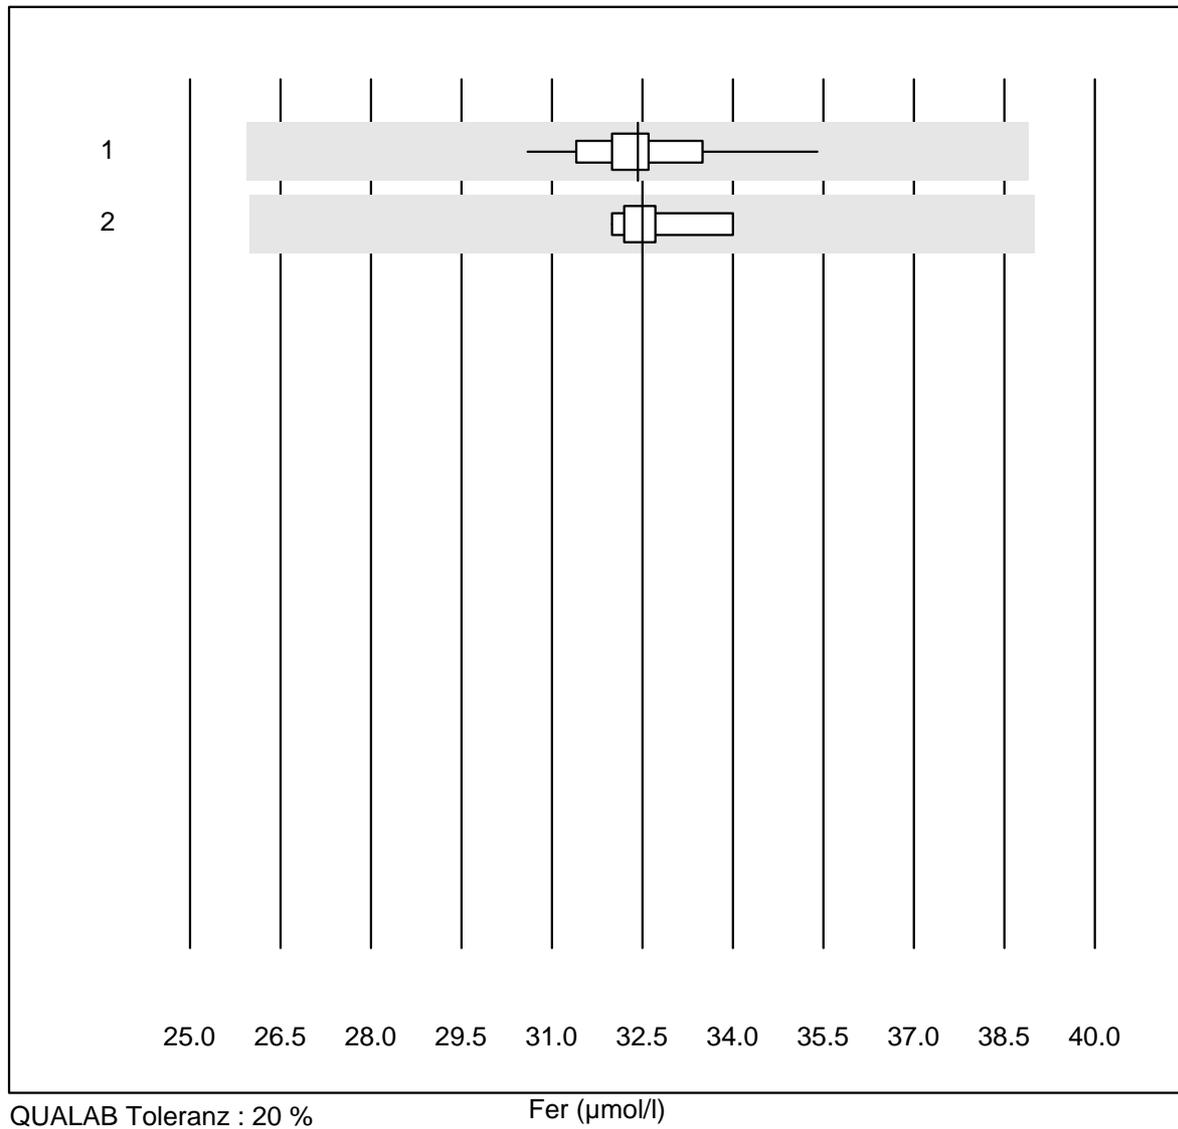


QUALAB Toleranz : 20 %

Fer (µmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	19	100.0	0.0	0.0	32	2.9	e
2	Cobas	9	100.0	0.0	0.0	33	1.9	e

Gamma-GT

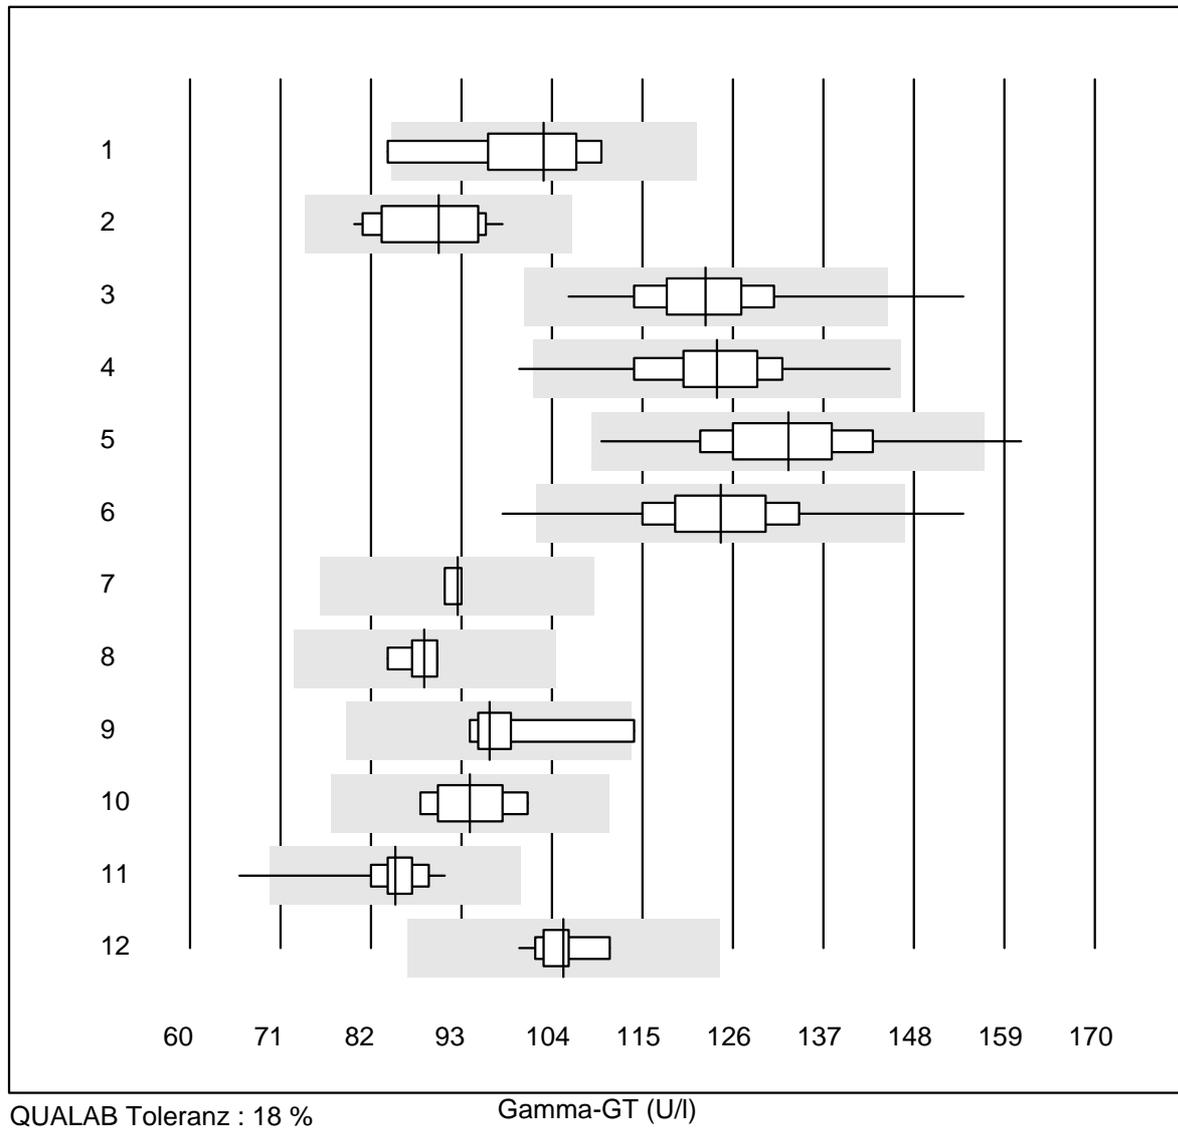


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	6	83.3	16.7	0.0	103	9.4	e*
2 Cobas	20	100.0	0.0	0.0	90	6.9	e
3 Reflotron	665	97.8	0.8	1.4	123	5.7	e
4 Fuji Dri-Chem	874	99.4	0.1	0.5	124	5.5	e
5 Spotchem/Ready	92	97.8	2.2	0.0	133	7.6	e
6 Spotchem D-Concept	314	99.4	0.6	0.0	124	6.3	e
7 Selectra/Biolis	6	100.0	0.0	0.0	93	1.1	e
8 Architect	6	100.0	0.0	0.0	89	2.6	e
9 Dimension	9	88.9	11.1	0.0	96	6.3	e
10 IFCC Beckmann	7	100.0	0.0	0.0	94	4.7	e
11 Piccolo	42	97.6	2.4	0.0	85	4.7	e
12 Hitachi S40/M40	13	92.3	0.0	7.7	105	3.0	e
13 Autolyser/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	93	2.2	e

Glucose

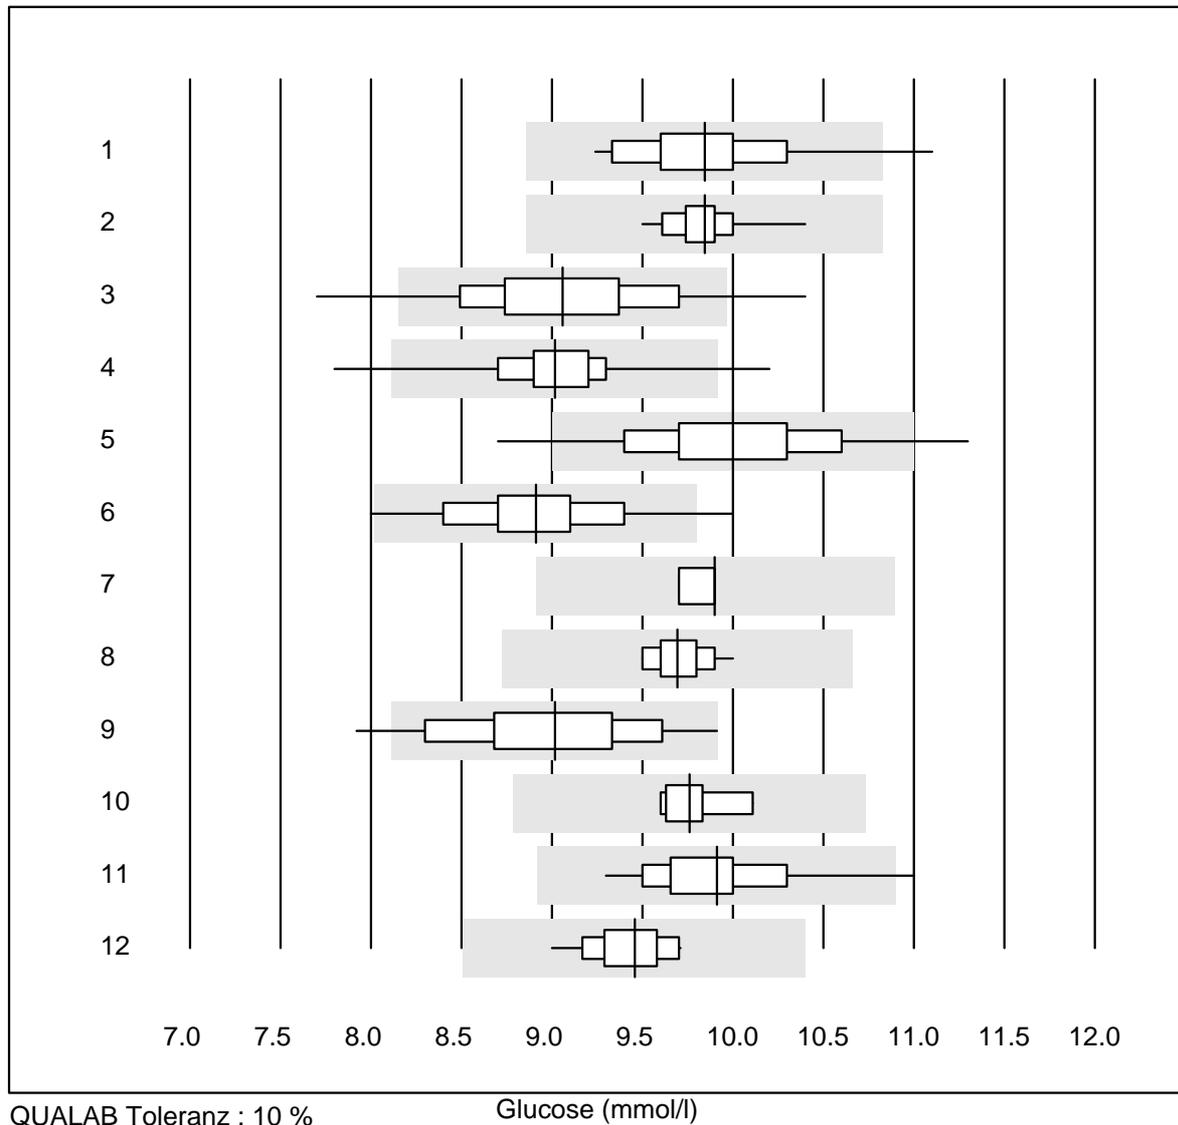


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	29	96.6	3.4	0.0	9.8	4.0	e
2	Cobas	17	100.0	0.0	0.0	9.8	2.1	e
3	Reflotron	652	93.8	4.8	1.4	9.1	5.0	e
4	Fuji Dri-Chem	827	99.4	0.5	0.1	9.0	2.6	e
5	Spotchem/Ready	82	90.3	8.5	1.2	10.0	5.3	e
6	Spotchem D-Concept	289	97.3	1.7	1.0	8.9	4.3	e
7	Dimension	4	100.0	0.0	0.0	9.9	1.0	e
8	Piccolo	54	98.1	0.0	1.9	9.7	1.3	e
9	Cholestech LDX	94	95.7	3.2	1.1	9.0	5.4	e
10	Abx Mira	6	100.0	0.0	0.0	9.8	1.9	e
11	Hitachi S40/M40	16	93.7	6.3	0.0	9.9	3.9	e
12	Autolyser/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	9.5	2.1	e
13	iStat Chem8	5	100.0	0.0	0.0	8.7	1.0	e

Glucose

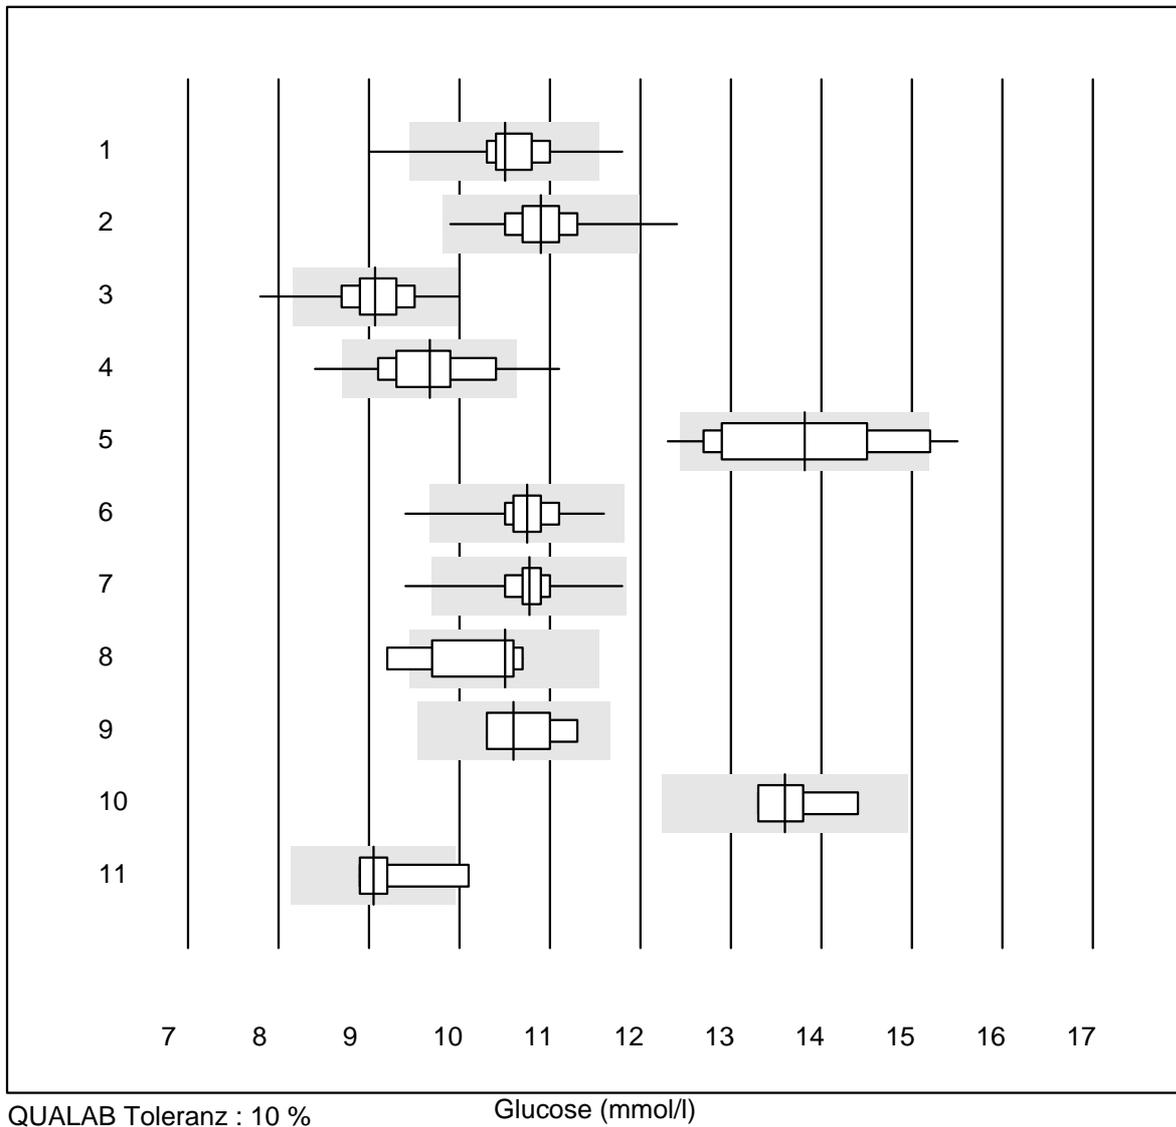


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Accu-Chek Aviva	293	95.9	1.7	2.4	10.5	3.3	e
2	Accu-Chek Inform 2	622	99.5	0.5	0.0	10.9	2.9	e
3	Accu-Check Guide	186	96.2	2.2	1.6	9.1	3.8	e
4	Contour XT	1119	93.4	5.8	0.8	9.7	4.9	e
5	Glucocard	16	62.4	18.8	18.8	13.8	7.4	e*
6	Hemocue 201+ P-equiv	94	94.7	2.1	3.2	10.7	3.1	e
7	Hemocue 201RT P-equiv	100	99.0	1.0	0.0	10.8	2.6	e
8	FreeStyle Precision	7	85.7	14.3	0.0	10.5	5.5	e*
9	Freestyle Freedom li	5	100.0	0.0	0.0	10.6	4.1	e*
10	Sanofi BG Star	4	100.0	0.0	0.0	13.6	3.6	e*
11	Contour NEXT ONE	4	75.0	25.0	0.0	9.1	6.1	e*

Glucose

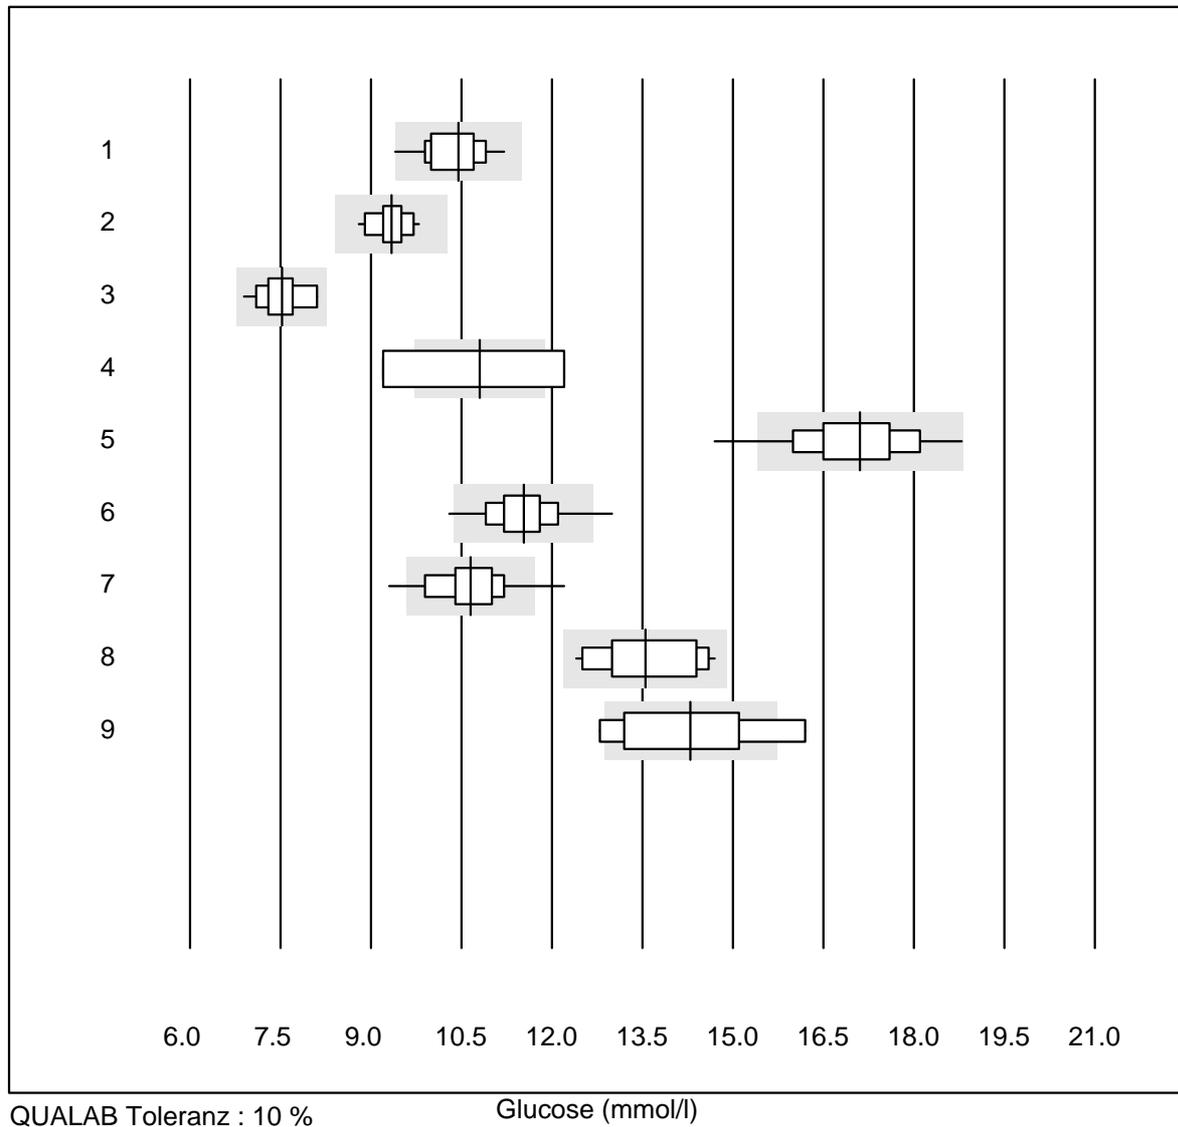

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Hemocue 201+ (alt)	44	97.7	2.3	0.0	10.5	4.0	e
2	OneTouch Verio	26	100.0	0.0	0.0	9.3	3.0	e
3	Contour 2 (5s)	24	87.5	0.0	12.5	7.5	4.7	e
4	Contour (15s)	6	0.0	50.0	50.0	10.8	16.3	e*
5	Healthpro	43	95.4	2.3	2.3	17.1	5.0	e
6	Mylife UNIO	248	99.2	0.8	0.0	11.5	3.9	e
7	mylife Pura	75	94.7	5.3	0.0	10.7	4.8	e
8	Omnitest	18	94.4	0.0	5.6	13.5	5.6	e*
9	Alpha Check	7	57.1	28.6	14.3	14.3	8.7	e*

Acide urique

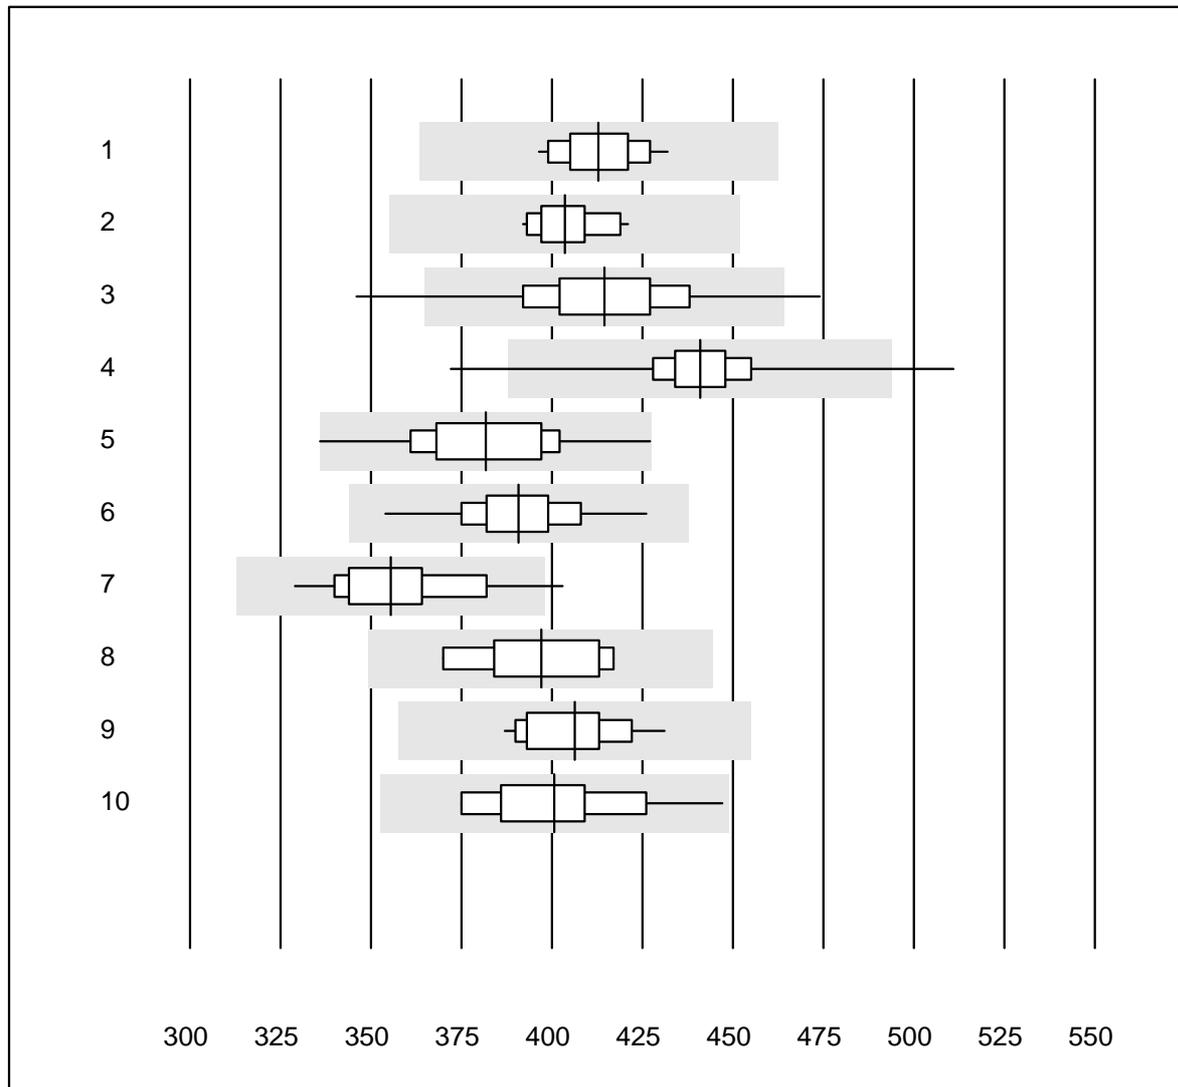


QUALAB Toleranz : 12 %

Acide urique (µmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	28	100.0	0.0	0.0	413	2.4	e
2	Cobas	16	100.0	0.0	0.0	404	2.3	e
3	Reflotron	581	96.9	1.0	2.1	415	4.5	e
4	Fuji Dri-Chem	815	99.0	0.5	0.5	441	2.7	e
5	Spotchem/Ready	72	98.6	0.0	1.4	382	4.8	e
6	Spotchem D-Concept	291	99.3	0.0	0.7	391	3.3	e
7	Piccolo	30	93.4	3.3	3.3	355	4.6	e
8	Abx Mira	6	83.3	0.0	16.7	397	5.2	e*
9	Hitachi S40/M40	13	100.0	0.0	0.0	406	3.2	e
10	Autolyser/DiaSys	17	100.0	0.0	0.0	401	5.0	e

Urée

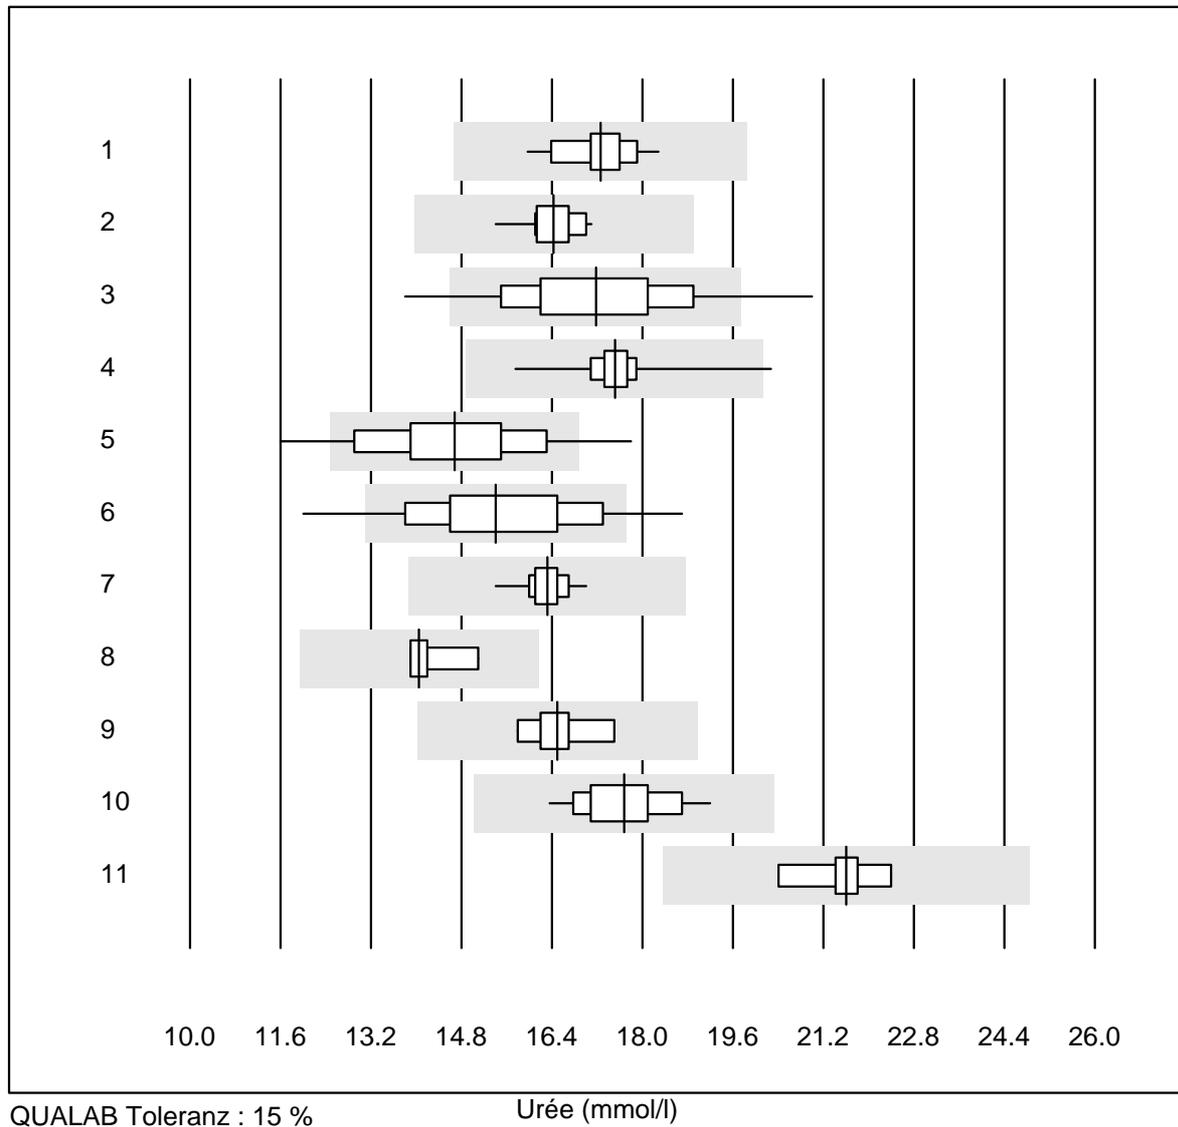

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Chimie humide	27	100.0	0.0	0.0	17.3	3.1	e
2 Cobas	19	100.0	0.0	0.0	16.4	2.4	e
3 Reflotron	260	96.2	2.3	1.5	17.2	7.4	e
4 Fuji Dri-Chem	484	99.4	0.2	0.4	17.5	2.1	e
5 Spotchem/Ready	50	88.0	12.0	0.0	14.7	9.0	e
6 Spotchem D-Concept	175	85.8	9.1	5.1	15.4	9.1	e
7 Piccolo	50	96.0	0.0	4.0	16.3	1.8	e
8 Skyla	4	100.0	0.0	0.0	14.1	4.0	e*
9 Hitachi S40/M40	9	100.0	0.0	0.0	16.5	3.0	e
10 Autolyser/DiaSys	14	100.0	0.0	0.0	17.7	4.3	e
11 iStat Chem8	5	100.0	0.0	0.0	21.6	3.4	e

Potassium

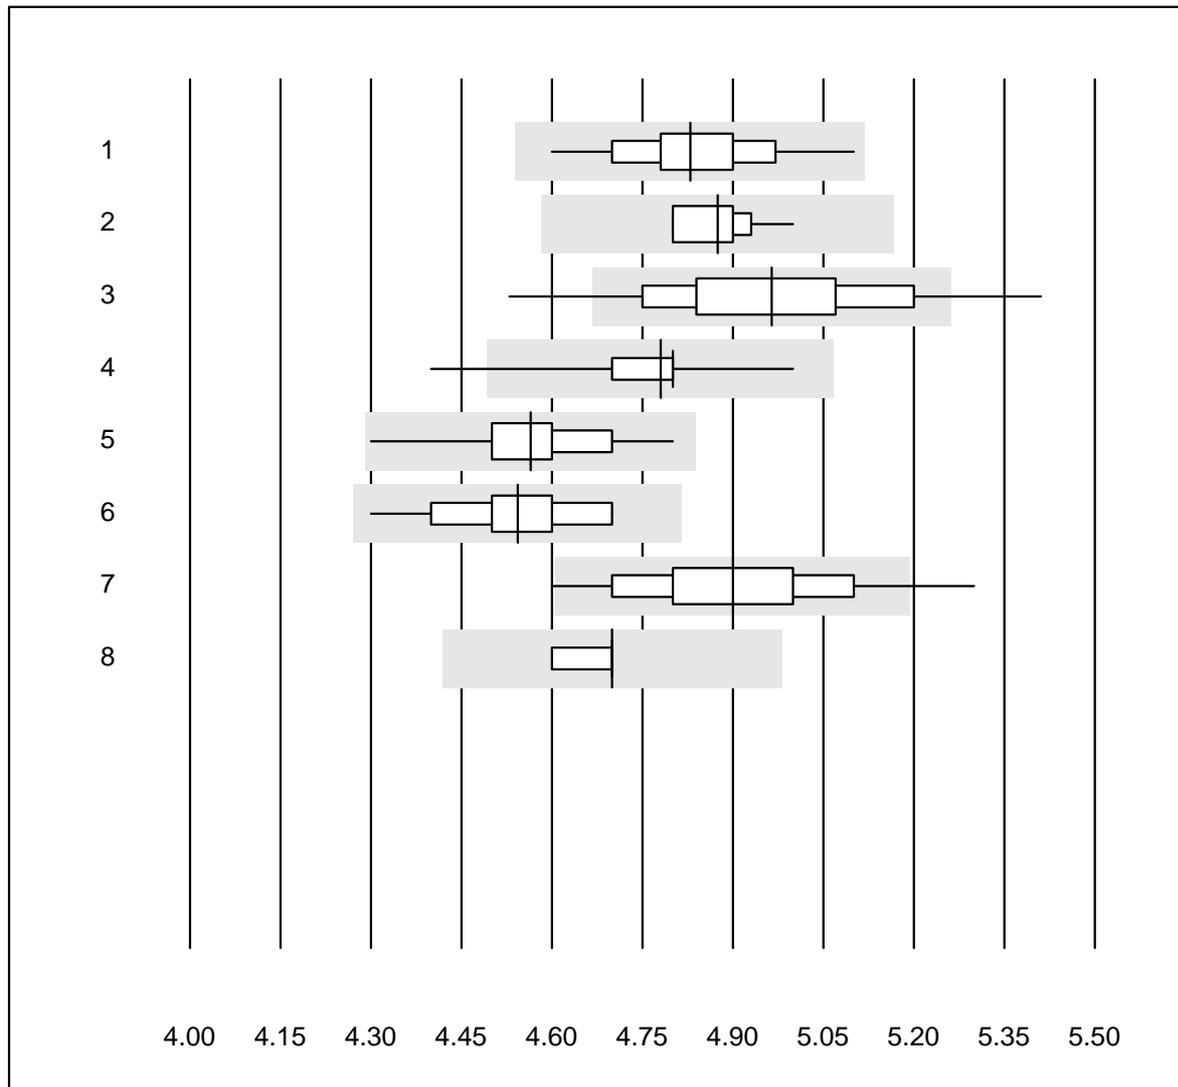


QUALAB Toleranz : 6 %

Potassium (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 ISE	44	97.7	0.0	2.3	4.83	2.2	e
2 Cobas	20	100.0	0.0	0.0	4.88	1.2	e
3 Reflotron	594	88.6	7.4	4.0	4.96	3.4	e
4 Fuji Dri-Chem	862	99.1	0.1	0.8	4.78	1.5	e
5 Spotchem D-Concept	291	98.6	0.0	1.4	4.56	1.7	e
6 Spotchem EL-SE 1520	81	97.5	0.0	2.5	4.54	2.3	e
7 Piccolo	40	75.0	15.0	10.0	4.90	3.3	e
8 iStat Chem8	8	100.0	0.0	0.0	4.70	0.8	e

Créatinine

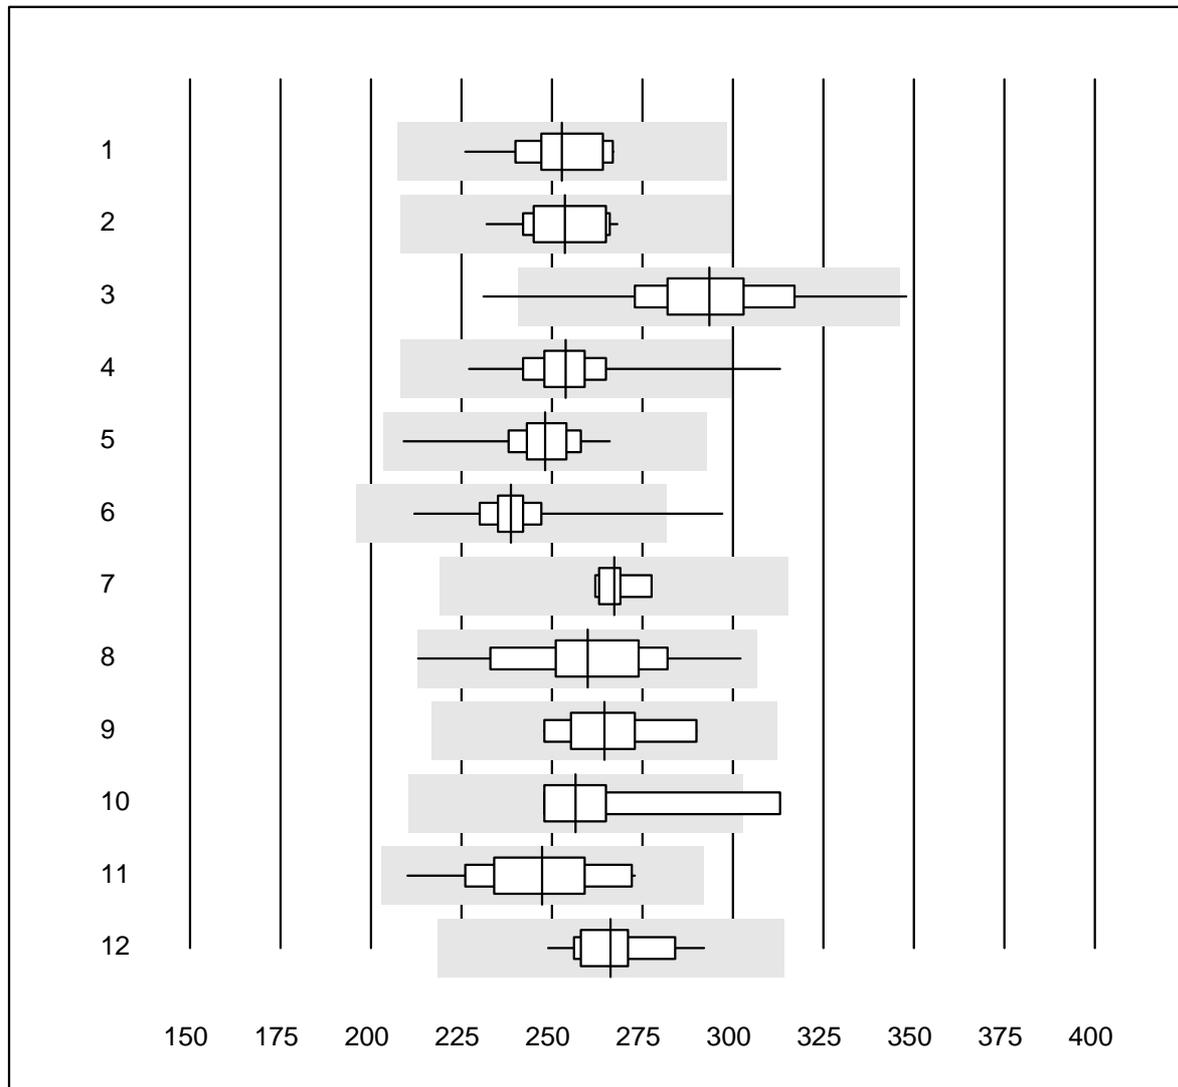


QUALAB Toleranz : 18 %

Créatinine (µmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	15	100.0	0.0	0.0	253	4.4	e
2	Cobas	21	100.0	0.0	0.0	254	4.2	e
3	Reflotron	773	98.3	0.5	1.2	293	6.2	e
4	Fuji Dri-Chem	894	99.5	0.1	0.4	254	3.6	e
5	Spotchem/Ready	100	100.0	0.0	0.0	248	3.7	e
6	Spotchem D-Concept	308	98.8	0.6	0.6	239	3.4	e
7	Enzymatisch	8	100.0	0.0	0.0	267	2.0	e
8	Piccolo	55	96.4	1.8	1.8	260	7.5	e
9	Abx Mira	8	100.0	0.0	0.0	265	5.1	e
10	Skyla	4	75.0	25.0	0.0	257	11.4	e*
11	Hitachi S40/M40	16	100.0	0.0	0.0	247	7.0	e
12	Autolyser/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	266	3.9	e
13	Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	253	1.7	e
14	EPOC	5	100.0	0.0	0.0	231	2.1	e

Créatinine E

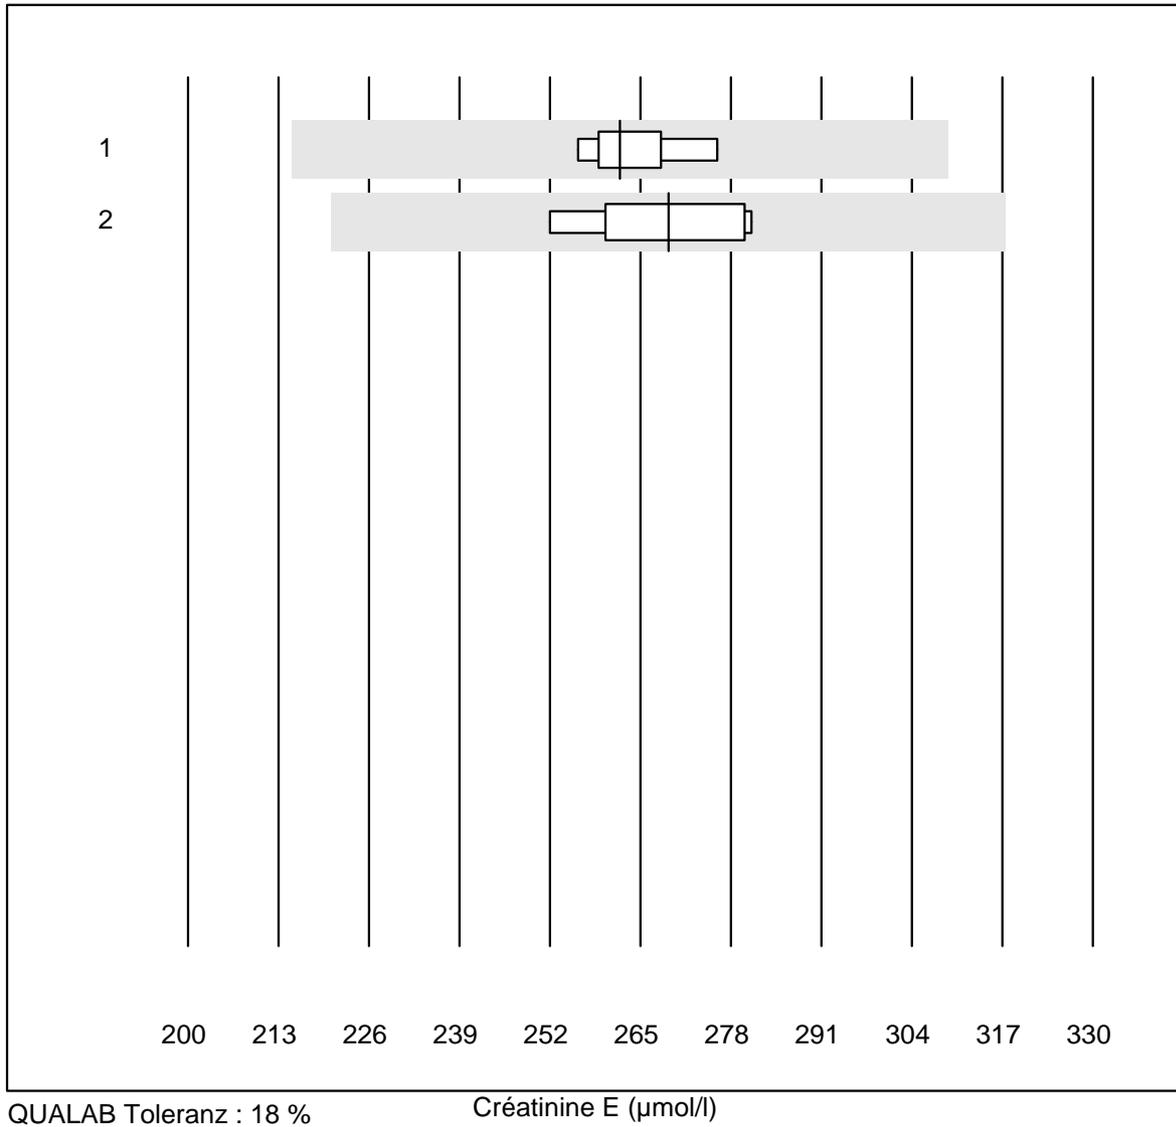


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	iStat Chem8	9	100.0	0.0	0.0	262	2.8	e
2	ABL700/800	7	100.0	0.0	0.0	269	4.1	e

eGFR CKD-EPI

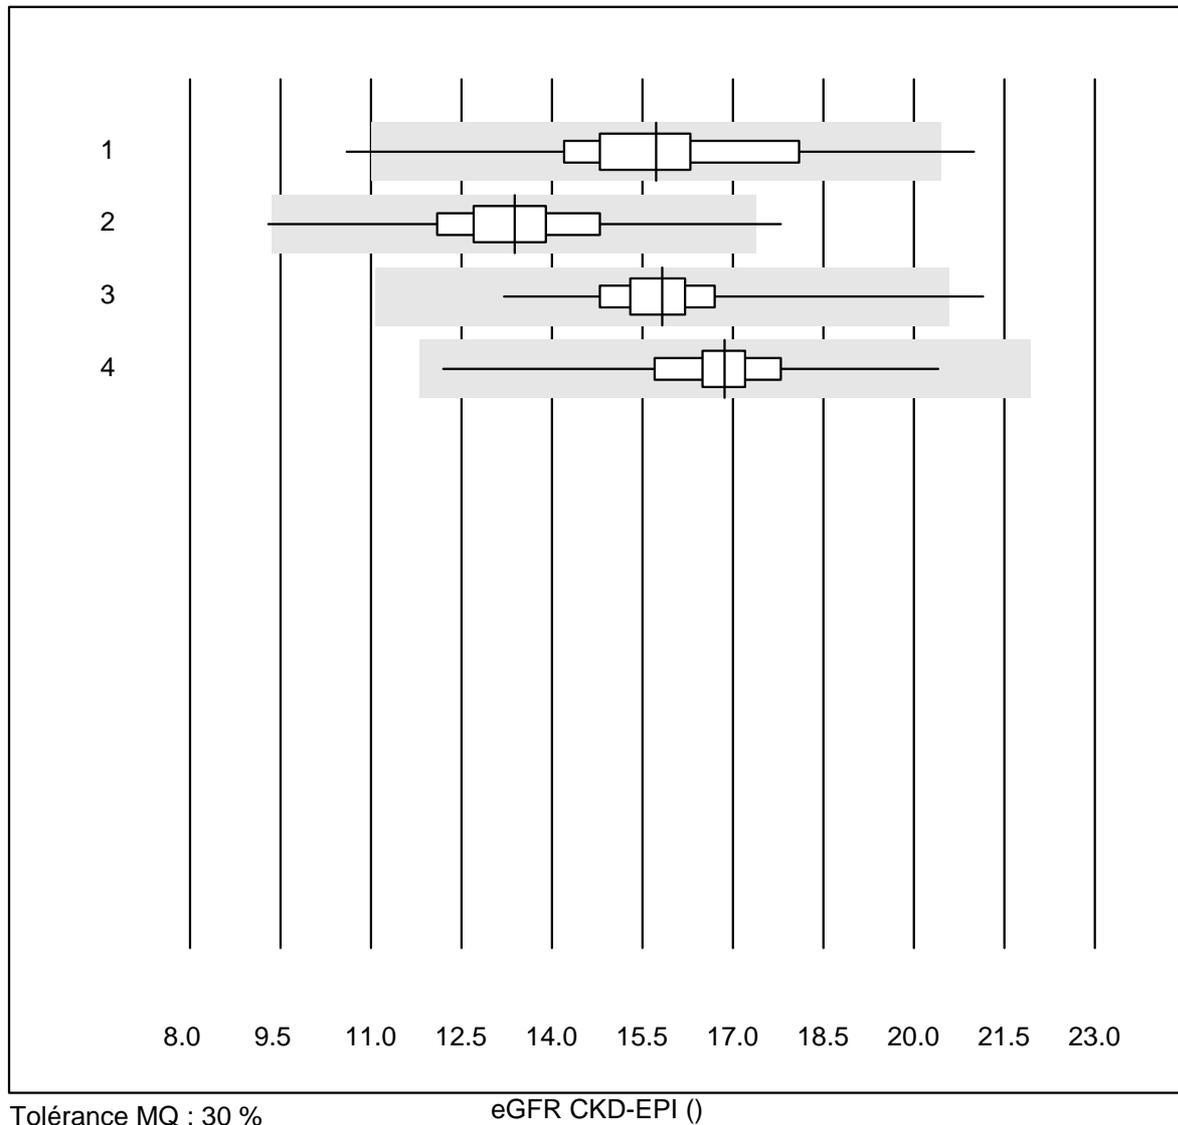

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	69	91.3	2.9	5.8	16	11.2	e
2	Reflotron	256	96.5	0.8	2.7	13	8.2	e
3	Fuji Dri-Chem	365	94.0	0.5	5.5	16	5.7	e
4	Spotchem/Ready	155	94.8	0.0	5.2	17	5.8	e

eGFR Cockcroft-Gault

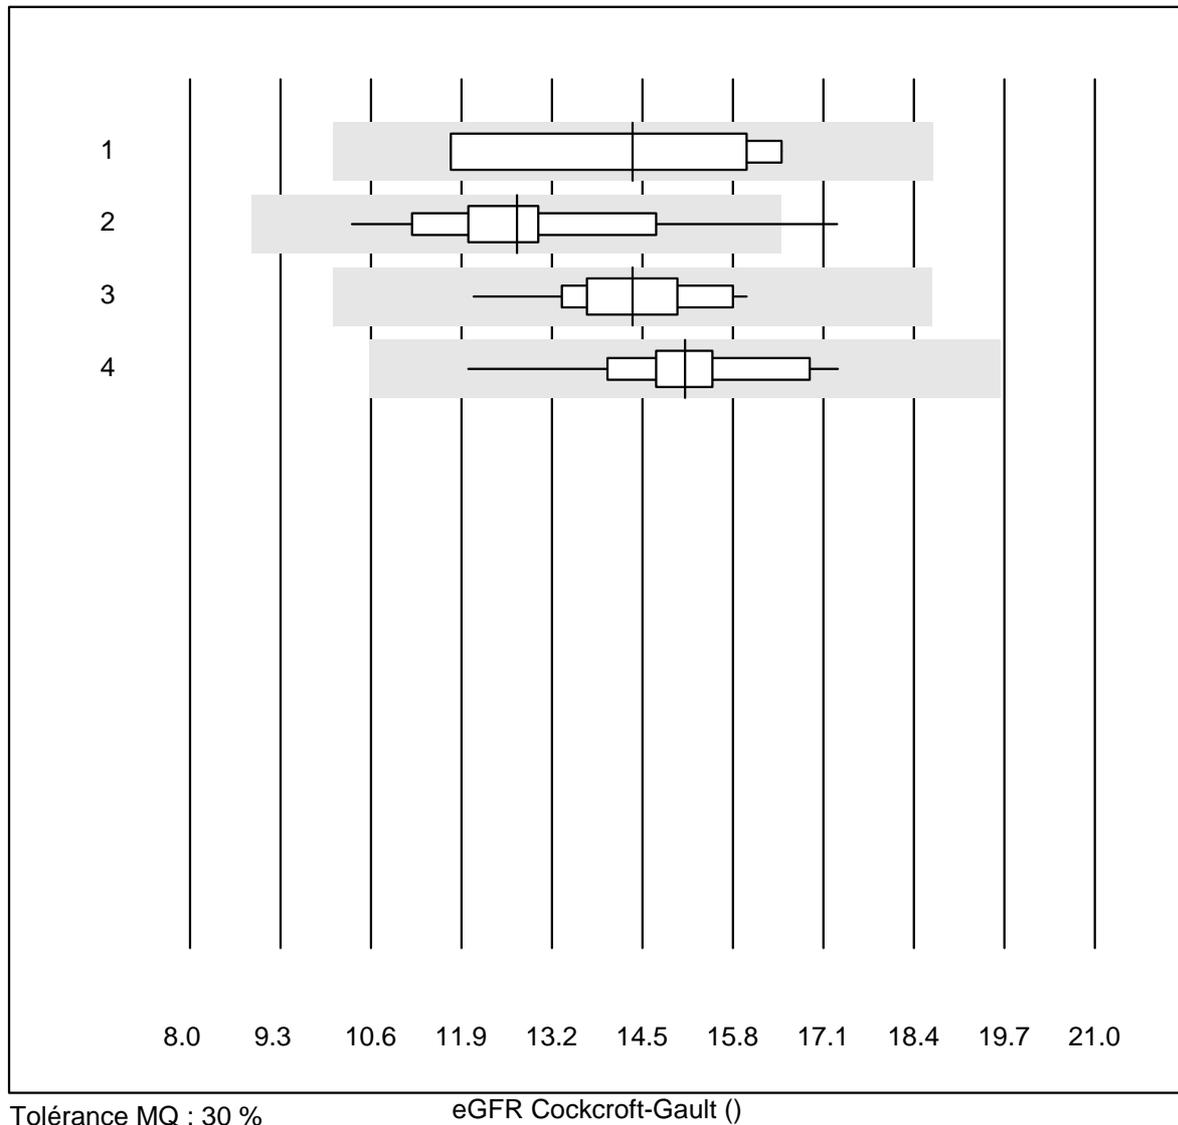


Tolérance MQ : 30 %

eGFR Cockcroft-Gault ()

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Chimie humide	4	100.0	0.0	0.0	14	16.6	e*
2 Reflotron	29	89.7	3.4	6.9	13	10.9	e
3 Fuji Dri-Chem	37	89.2	0.0	10.8	14	6.6	e
4 Spotchem/Ready	17	100.0	0.0	0.0	15	7.9	e

eGFR MDRD

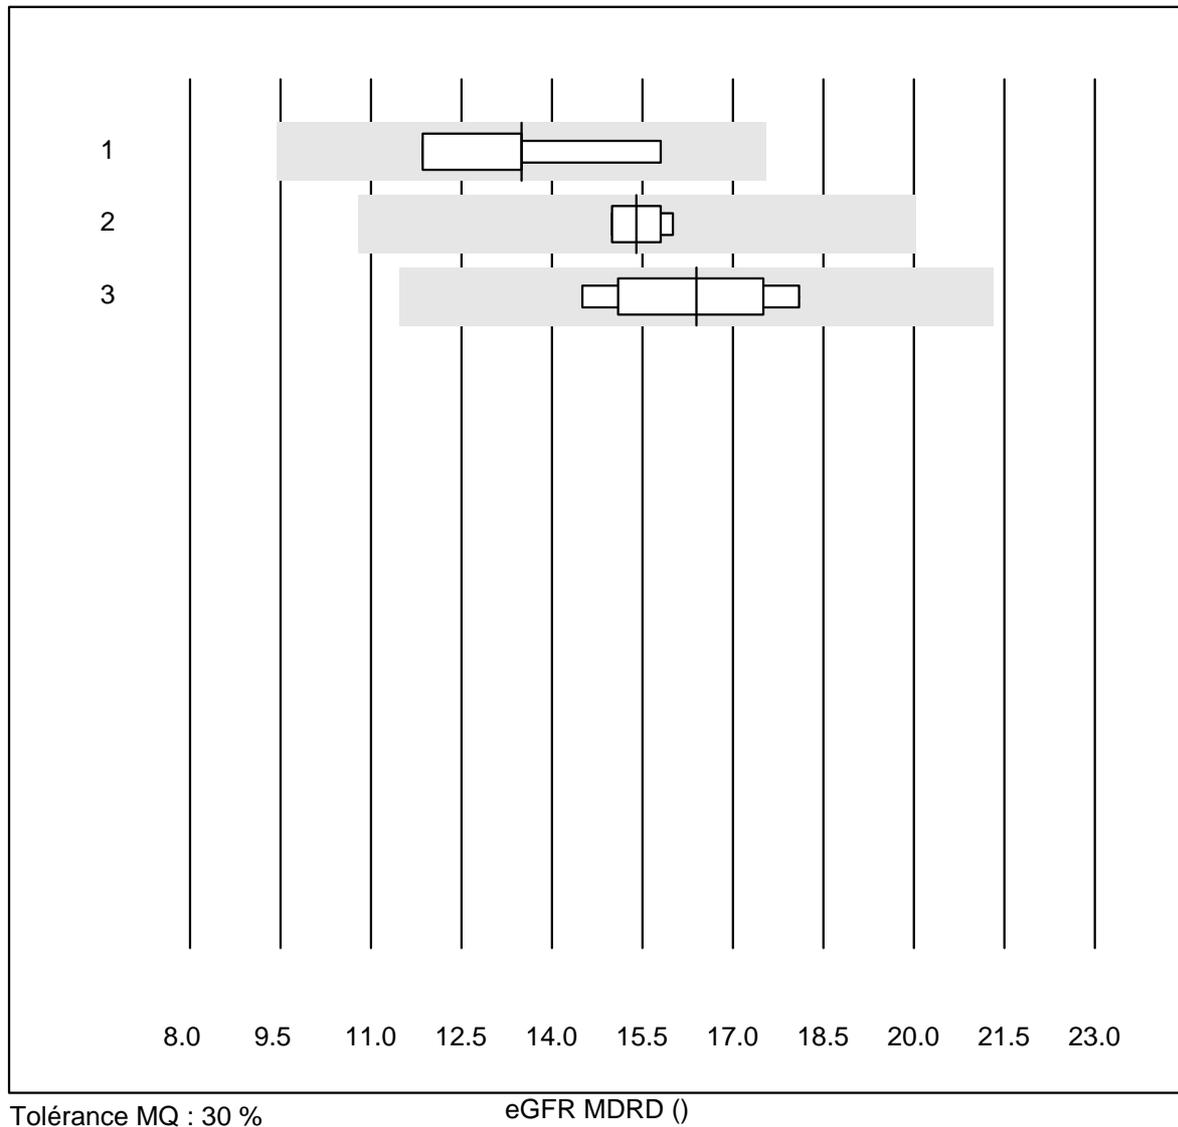


Tolérance MQ : 30 %

eGFR MDRD ()


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Reflotron	4	100.0	0.0	0.0	14	11.9	e*
2	Fuji Dri-Chem	4	100.0	0.0	0.0	15	3.4	e
3	Spotchem/Ready	5	100.0	0.0	0.0	16	9.4	e*

LDH

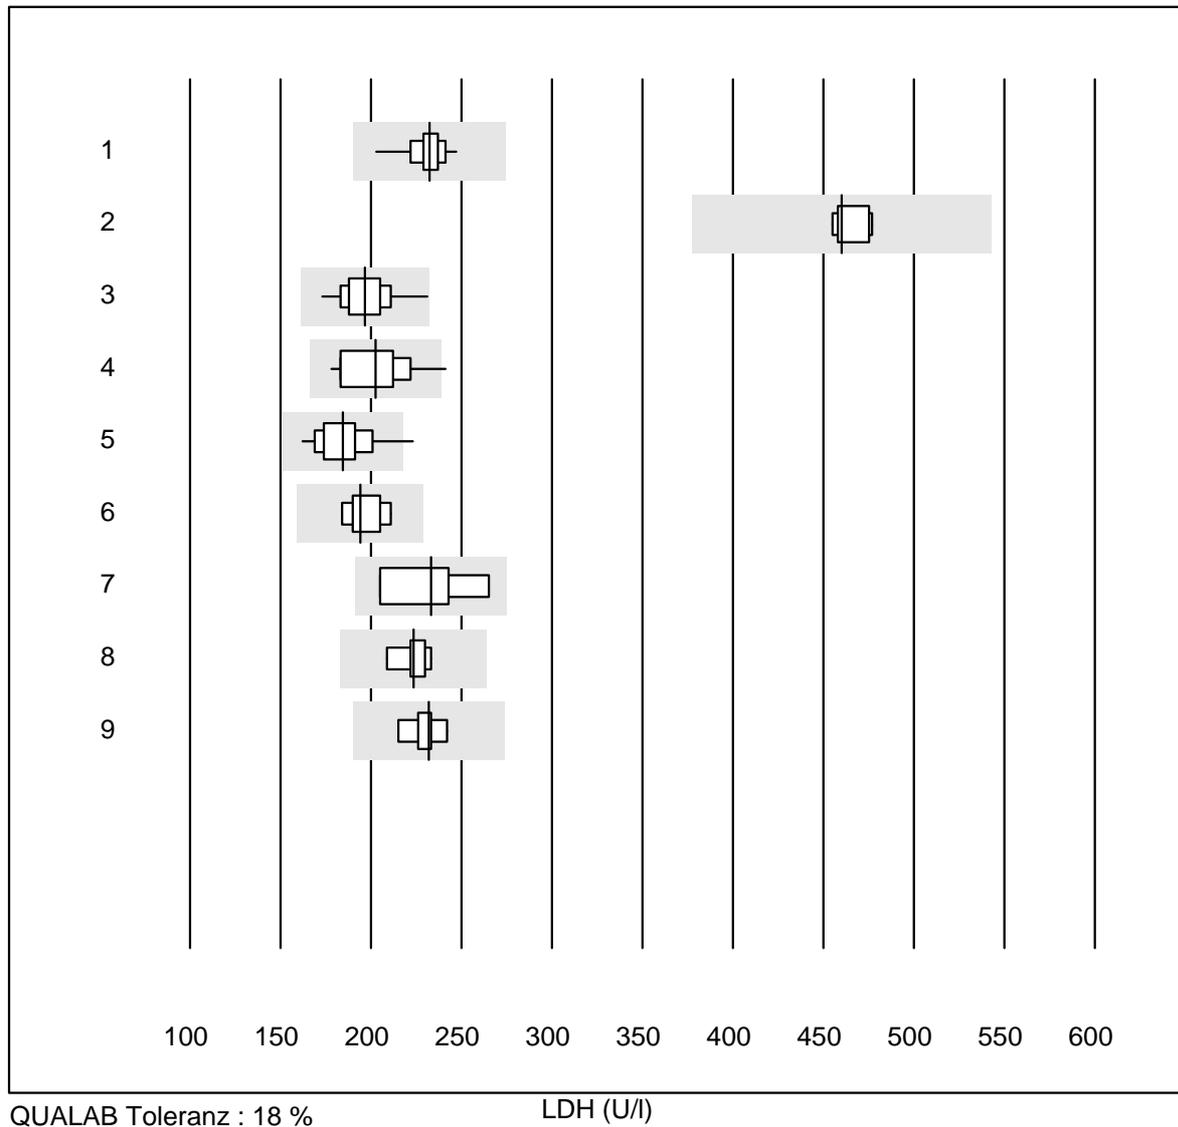

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	36	100.0	0.0	0.0	232	3.7	e
2 Cobas	7	100.0	0.0	0.0	460	1.9	e
3 Fuji Dri-Chem	143	97.2	0.0	2.8	197	5.8	e
4 Spotchem/Ready	13	84.6	7.7	7.7	202	9.0	e*
5 Spotchem D-Concept	57	98.2	1.8	0.0	184	7.1	e
6 Piccolo	6	100.0	0.0	0.0	194	5.1	e
7 Abx Mira	4	100.0	0.0	0.0	233	11.0	e*
8 Hitachi S40/M40	6	100.0	0.0	0.0	224	3.7	e
9 Autolyser/DiaSys	9	100.0	0.0	0.0	232	3.7	e

Magnésium

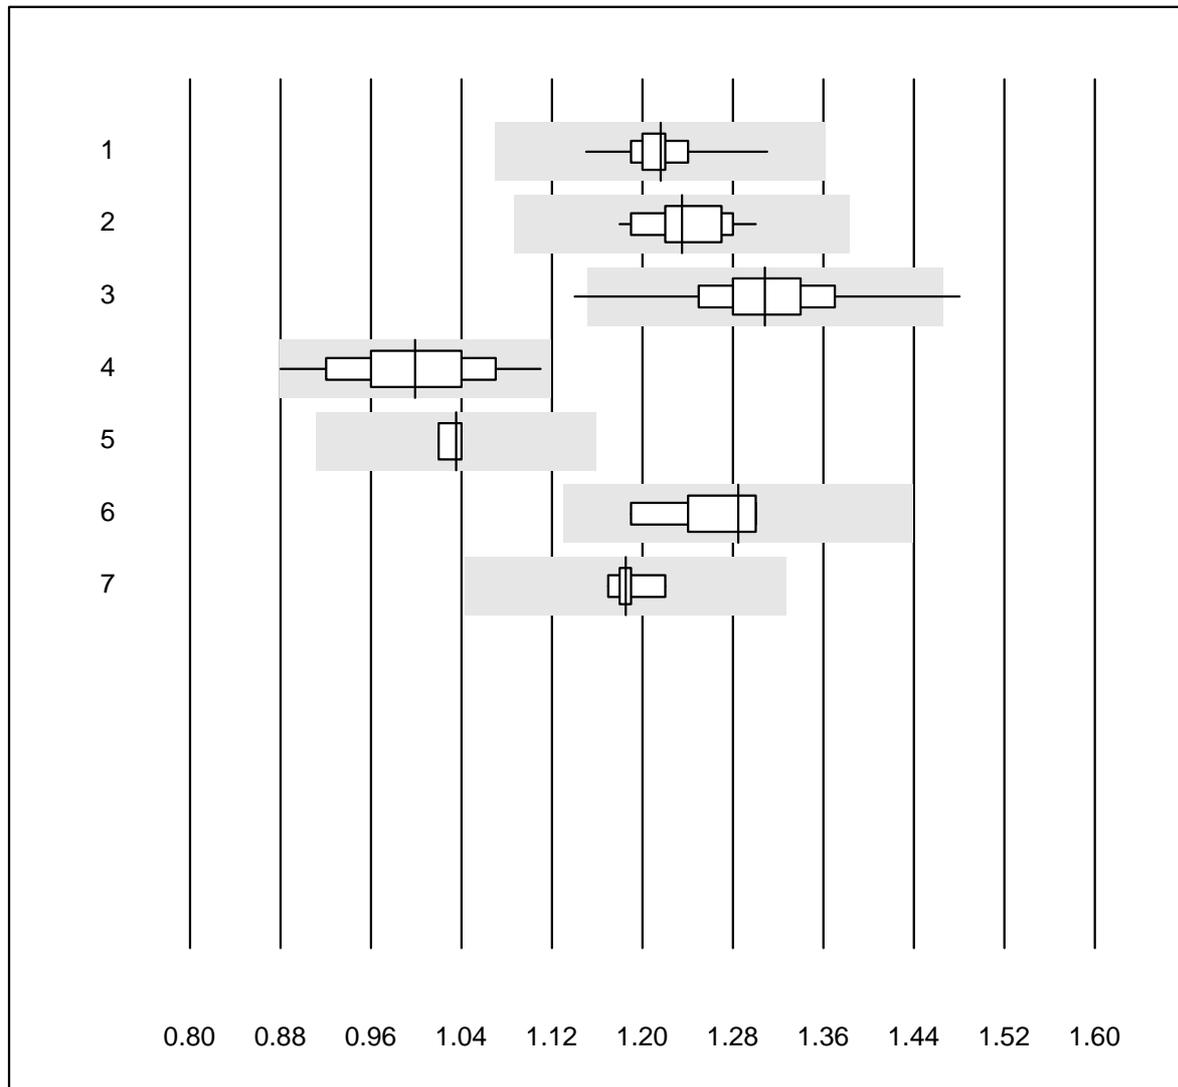


QUALAB Toleranz : 12 %

Magnésium (mmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	13	100.0	0.0	0.0	1.22	2.9	e
2	Cobas	15	100.0	0.0	0.0	1.23	2.7	e
3	Fuji Dri-Chem	113	96.5	3.5	0.0	1.31	4.3	e
4	Spotchem D-Concept	46	100.0	0.0	0.0	1.00	5.4	e
5	Spotchem/Ready	4	100.0	0.0	0.0	1.04	0.9	e
6	Beckman	6	100.0	0.0	0.0	1.29	3.4	e
7	Piccolo	8	87.5	0.0	12.5	1.19	1.3	e

Sodium

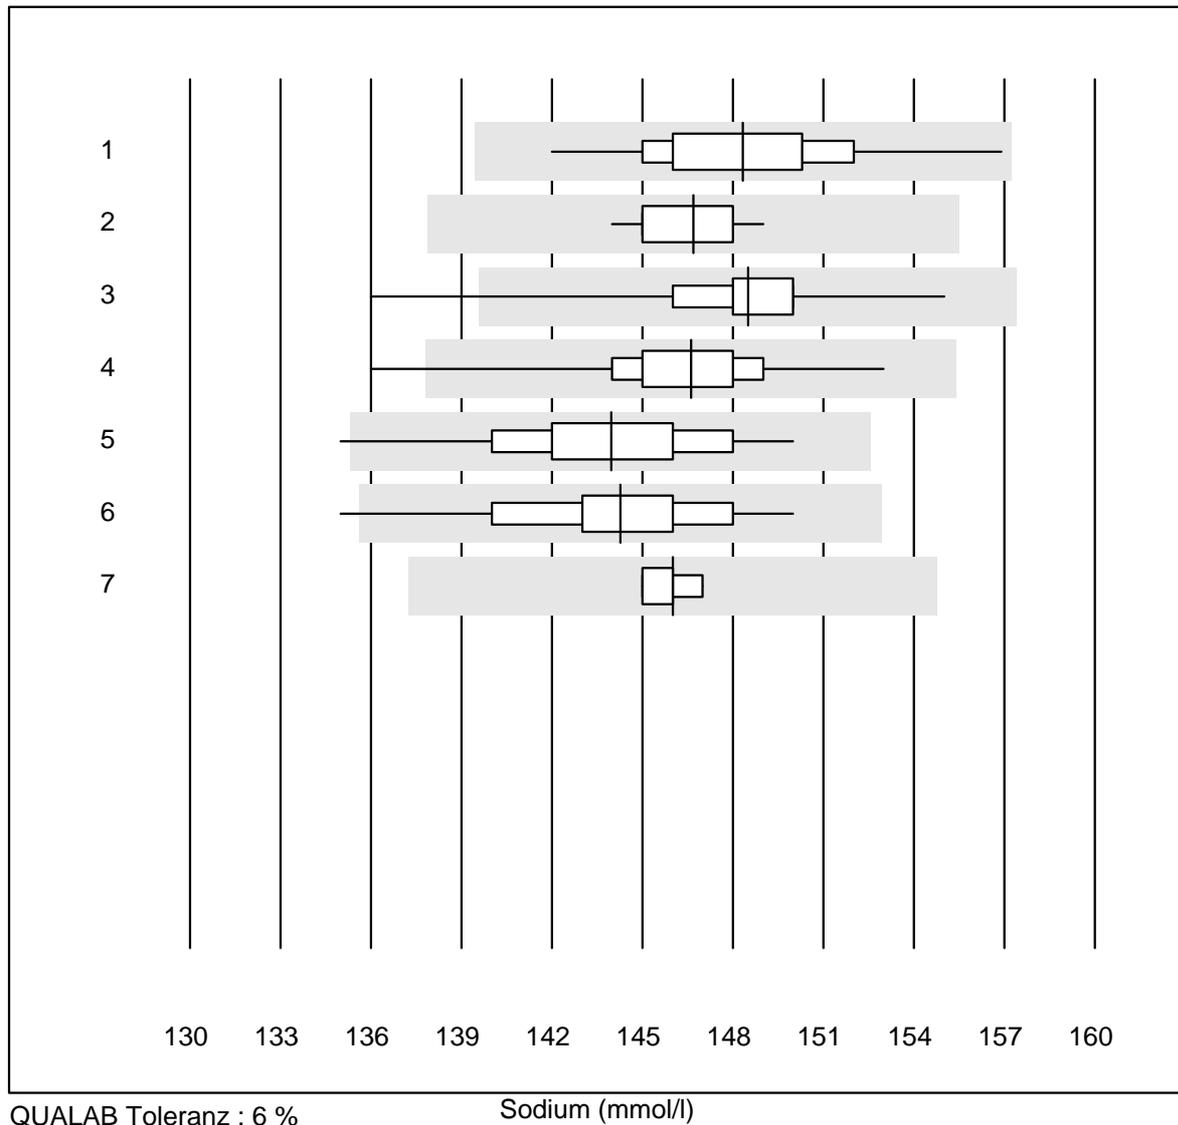

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 ISE	41	100.0	0.0	0.0	148	2.1	e
2 Cobas	20	100.0	0.0	0.0	147	1.0	e
3 Fuji Dri-Chem	805	99.4	0.2	0.4	148	1.3	e
4 Spotchem D-Concept	279	99.3	0.7	0.0	147	1.6	e
5 Spotchem EL-SE 1520	79	97.4	1.3	1.3	144	2.1	e
6 Piccolo	40	95.0	2.5	2.5	144	2.1	e
7 iStat Chem8	6	100.0	0.0	0.0	146	0.5	e

Phosphates

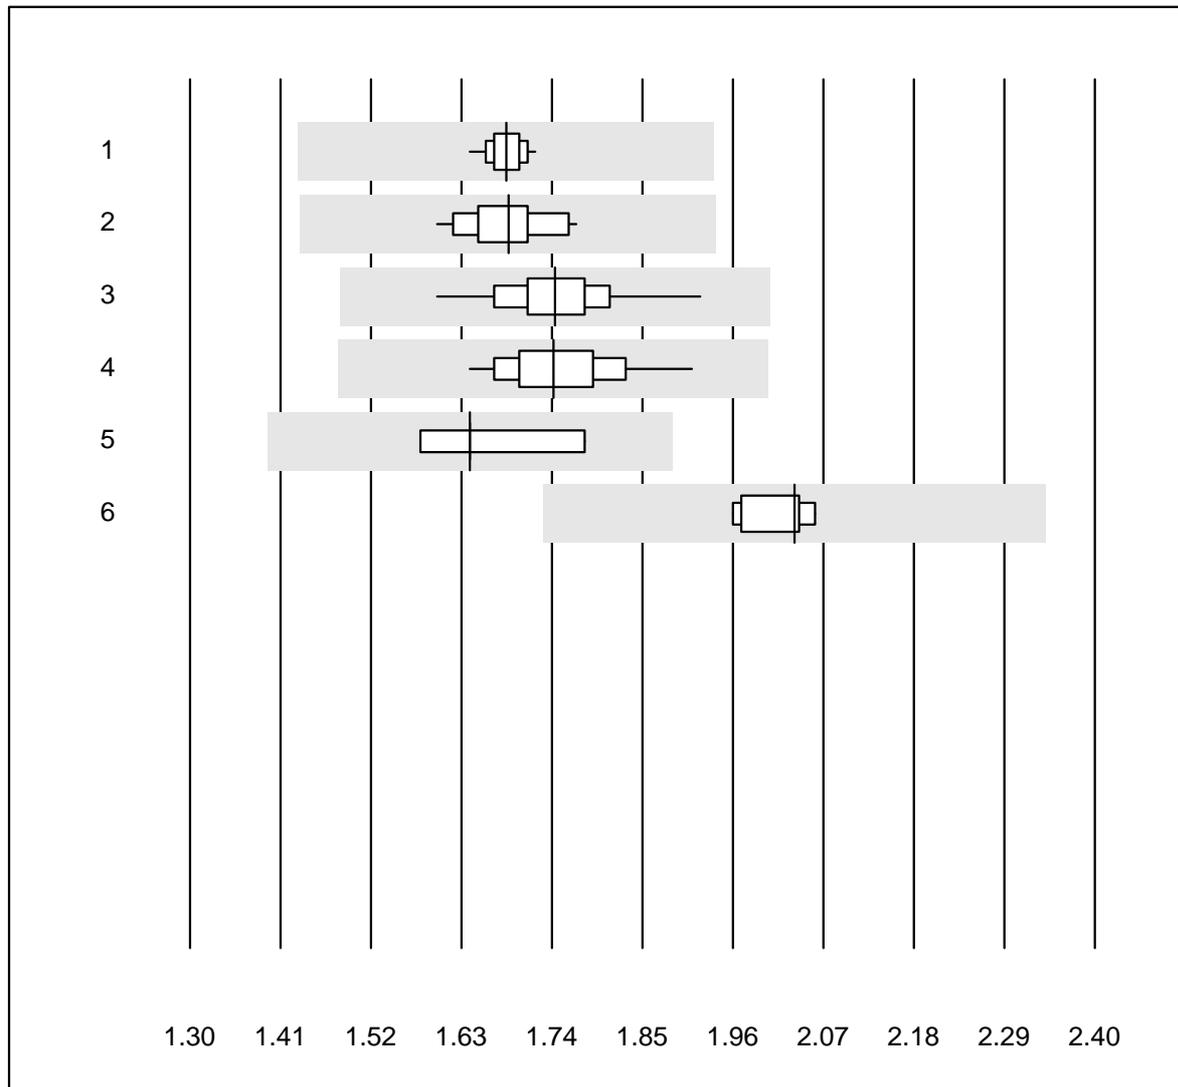


QUALAB Toleranz : 15 %

Phosphates (mmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	22	100.0	0.0	0.0	1.7	1.3	e
2	Cobas	16	100.0	0.0	0.0	1.7	3.0	e
3	Fuji Dri-Chem	81	98.8	0.0	1.2	1.7	3.4	e
4	Spotchem D-Concept	22	100.0	0.0	0.0	1.7	4.1	e
5	Spotchem/Ready	5	100.0	0.0	0.0	1.6	4.5	e*
6	Piccolo	6	100.0	0.0	0.0	2.0	2.0	e

Protéine

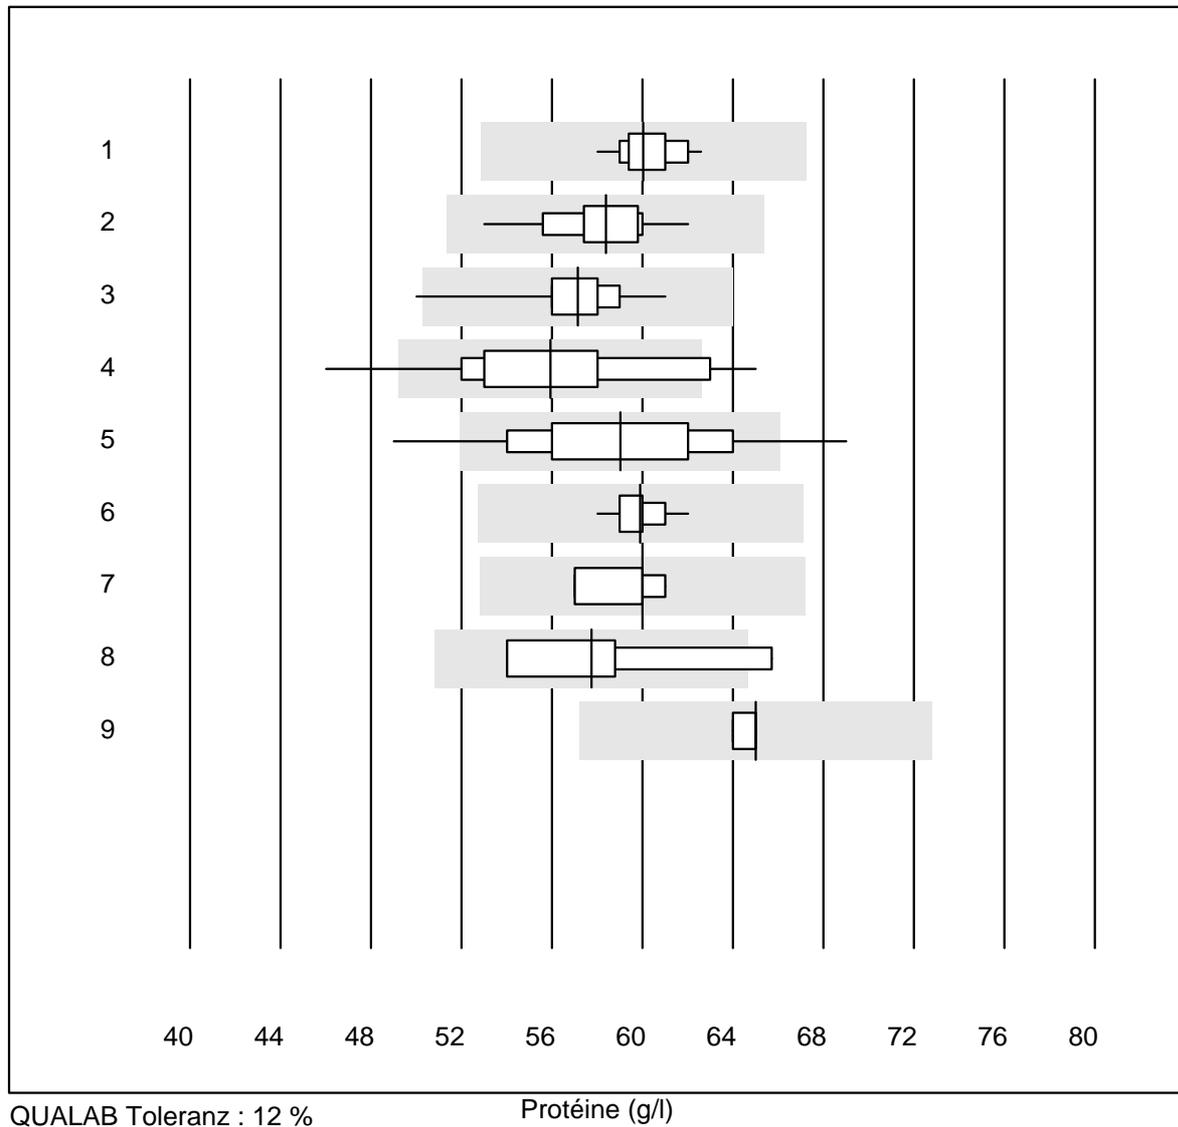

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	23	100.0	0.0	0.0	60.0	2.0	e
2	Cobas	16	100.0	0.0	0.0	58.4	3.7	e
3	Fuji Dri-Chem	174	98.3	0.6	1.1	57.1	2.6	e
4	Spotchem/Ready	28	82.1	14.3	3.6	55.9	7.4	e
5	Spotchem D-Concept	122	91.0	4.9	4.1	59.0	6.8	e
6	Piccolo	41	100.0	0.0	0.0	59.9	1.6	e
7	Skyla	4	100.0	0.0	0.0	60.0	2.9	e*
8	Abx Mira	4	75.0	25.0	0.0	57.8	8.5	e*
9	Hitachi S40/M40	5	100.0	0.0	0.0	65.0	0.8	e

Transaminase GOT/AST

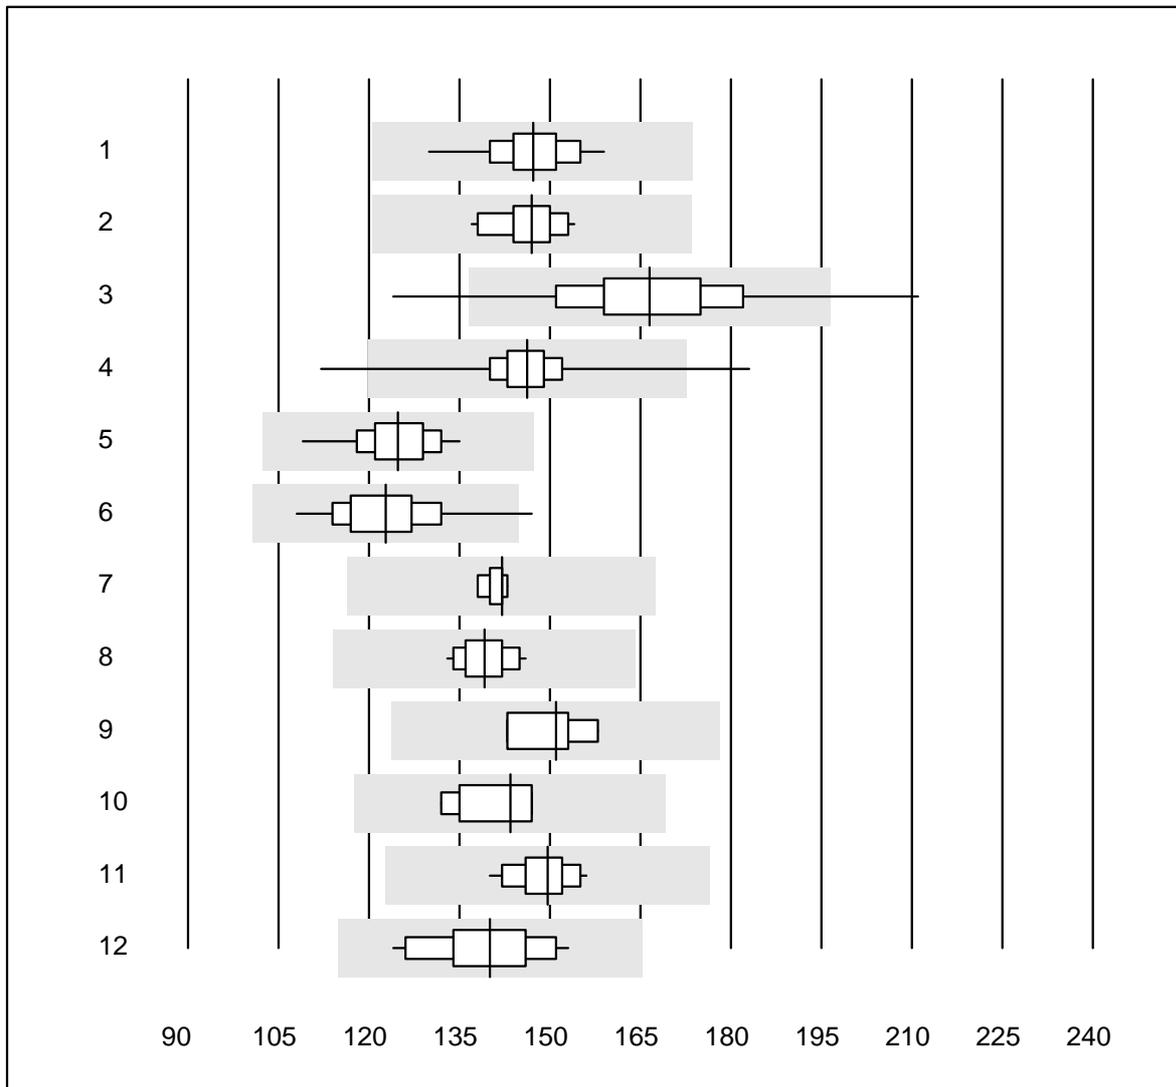


QUALAB Toleranz : 18 %

Transaminase GOT/AST (U/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC avec PP	29	100.0	0.0	0.0	147	4.2	e
2 Cobas	15	100.0	0.0	0.0	147	3.4	e
3 Reflotron	675	97.2	1.3	1.5	167	7.2	e
4 Fuji Dri-Chem	873	99.2	0.5	0.3	146	3.5	e
5 Spotchem/Ready	94	98.9	0.0	1.1	125	4.4	e
6 Spotchem D-Concept	310	98.4	1.3	0.3	123	6.0	e
7 IFCC sens PP	5	100.0	0.0	0.0	142	1.4	e
8 Piccolo	55	98.2	0.0	1.8	139	2.5	e
9 Skyla	4	100.0	0.0	0.0	151	4.2	e
10 Abx Mira	7	100.0	0.0	0.0	143	4.2	e
11 Hitachi S40/M40	16	100.0	0.0	0.0	150	3.0	e
12 Autolyser/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	140	5.6	e

Transaminase GPT/ALT

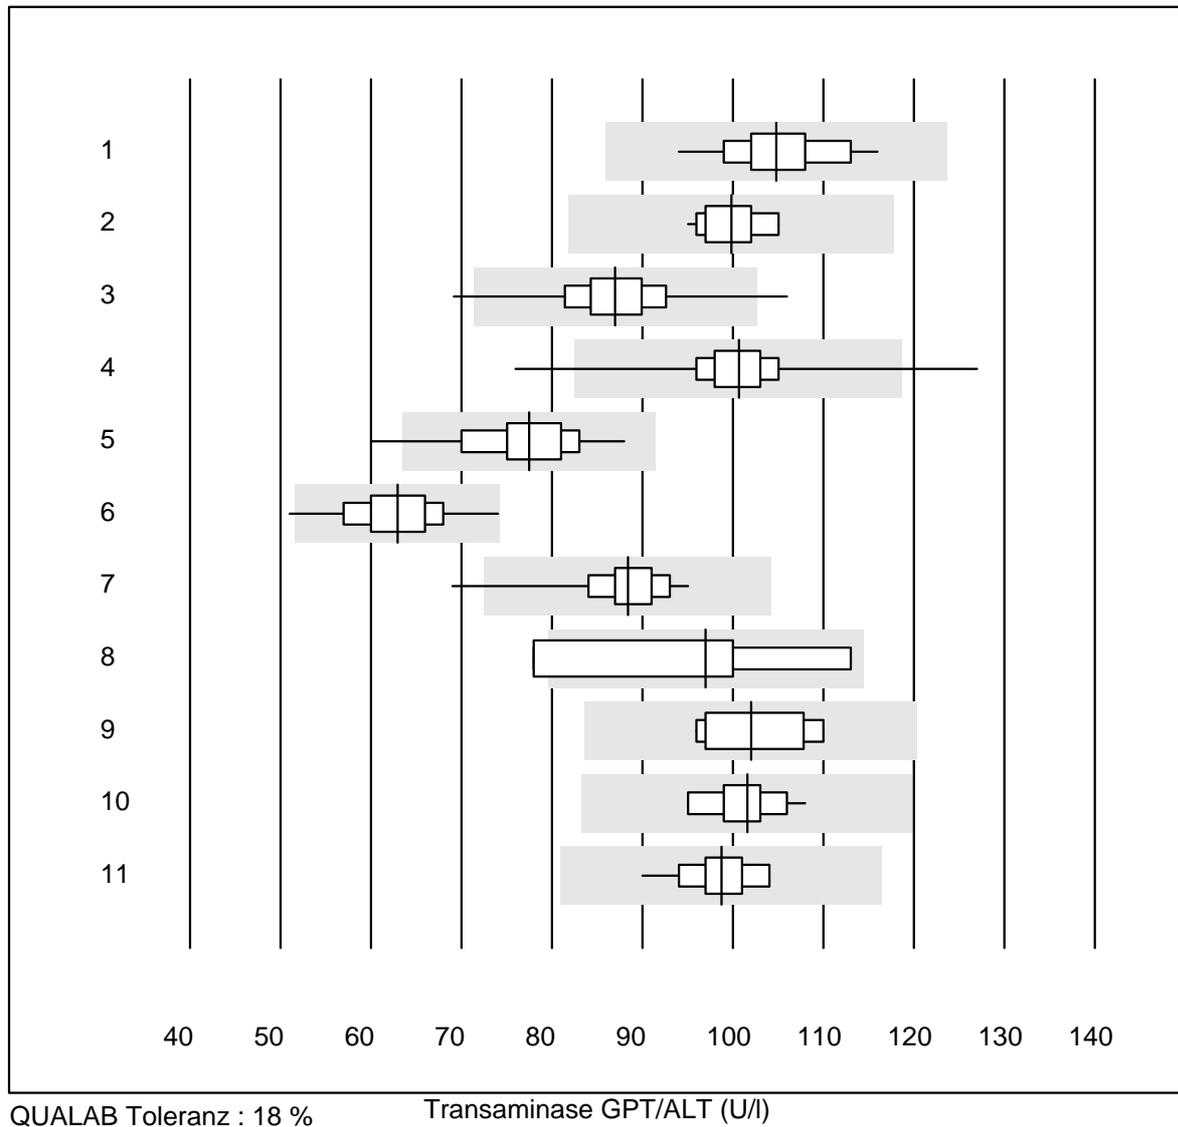

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC avec PP	27	100.0	0.0	0.0	105	4.9	e
2 Cobas	21	100.0	0.0	0.0	100	3.3	e
3 Reflotron	698	97.4	0.9	1.7	87	5.5	e
4 Fuji Dri-Chem	888	99.2	0.3	0.5	101	4.0	e
5 Spotchem/Ready	98	92.9	5.1	2.0	78	7.1	e
6 Spotchem D-Concept	313	98.0	1.0	1.0	63	6.8	e
7 Piccolo	55	96.4	1.8	1.8	88	5.3	e
8 Skyla	4	75.0	25.0	0.0	97	15.1	e*
9 Abx Mira	6	100.0	0.0	0.0	102	5.5	e*
10 Hitachi S40/M40	16	100.0	0.0	0.0	102	3.5	e
11 Autolyser/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	99	3.7	e

Triglycérides

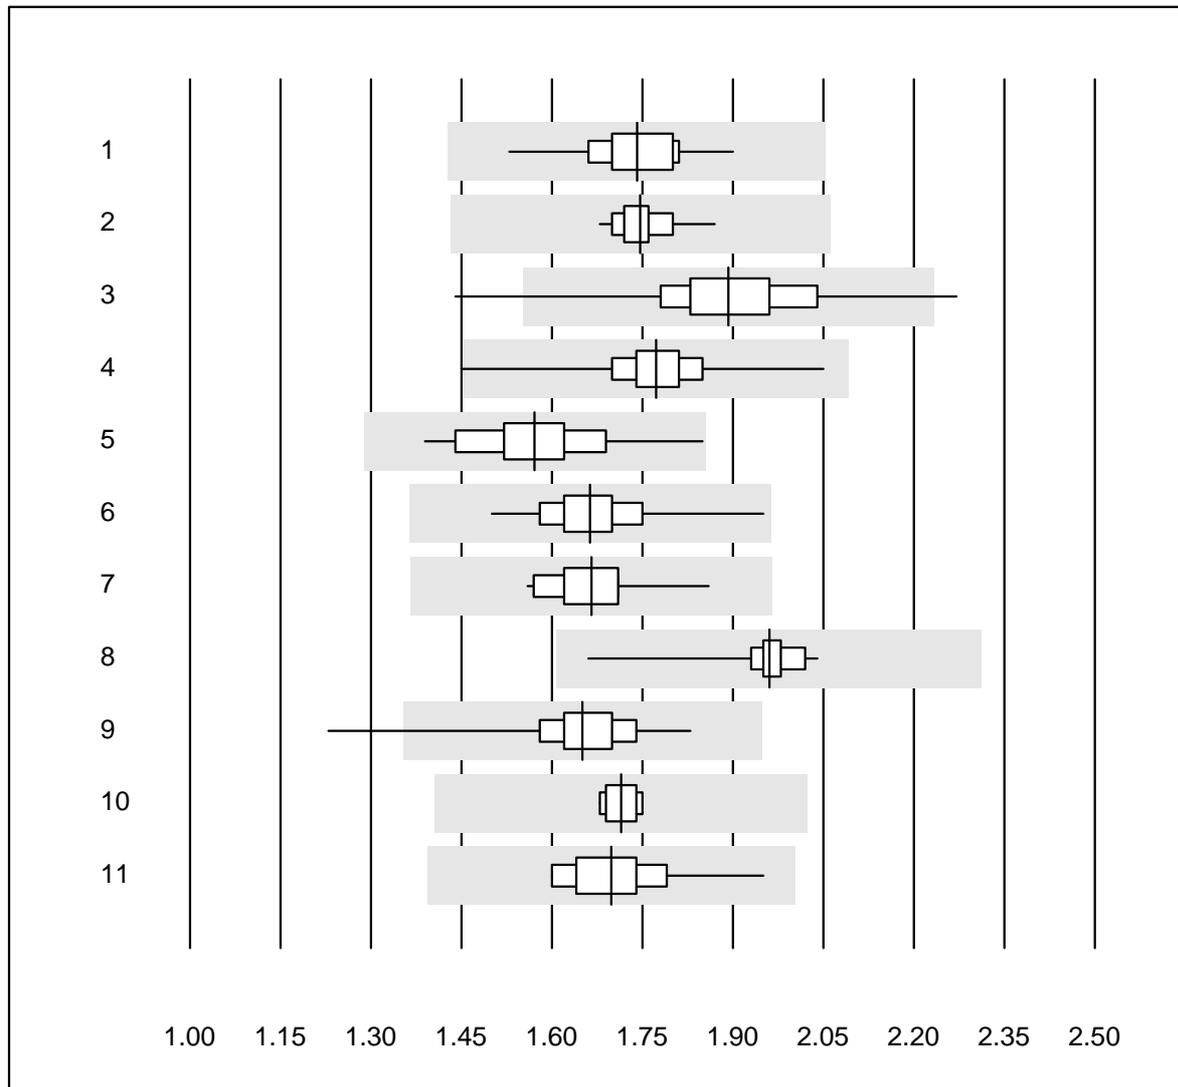


QUALAB Toleranz : 18 %

Triglycérides (mmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	27	100.0	0.0	0.0	1.74	4.6	e
2	Cobas	22	100.0	0.0	0.0	1.75	2.5	e
3	Reflotron	384	95.8	0.8	3.4	1.89	5.9	e
4	Fuji Dri-Chem	767	99.4	0.1	0.5	1.77	3.7	e
5	Spotchem/Ready	78	100.0	0.0	0.0	1.57	5.9	e
6	Spotchem D-Concept	277	98.2	0.0	1.8	1.66	4.0	e
7	Hitachi S40/M40	11	100.0	0.0	0.0	1.67	4.9	e
8	Piccolo	21	95.2	0.0	4.8	1.96	3.9	e
9	Cholestech LDX	110	96.4	1.8	1.8	1.65	5.2	e
10	Abx Mira	6	100.0	0.0	0.0	1.72	1.7	e
11	Autolyser/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	1.70	5.1	e

Lithium

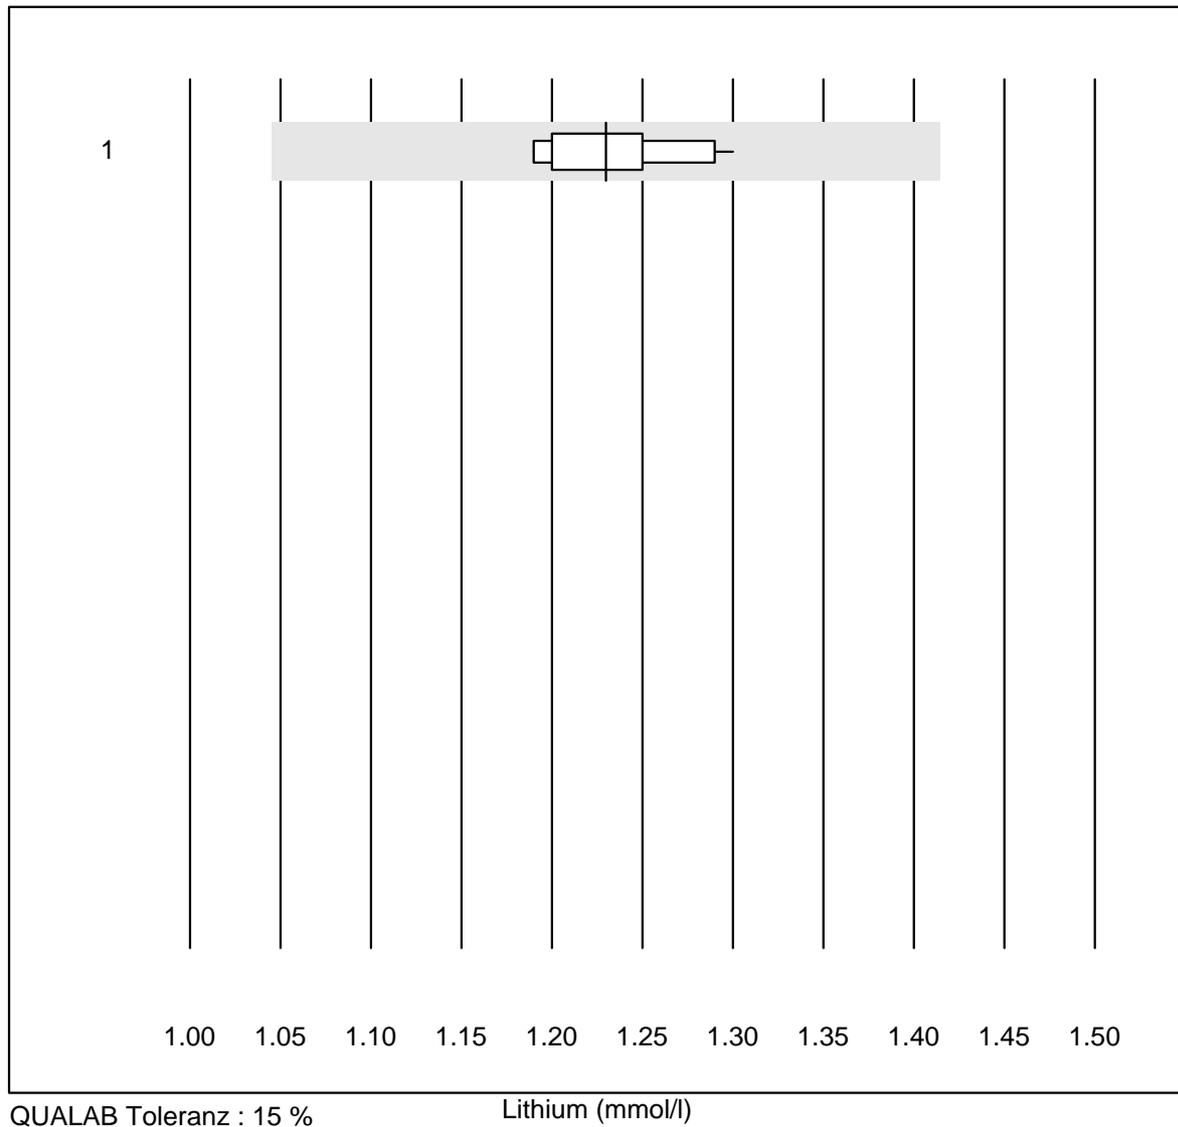


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	18	100.0	0.0	0.0	1.23	2.9	e

Laktat

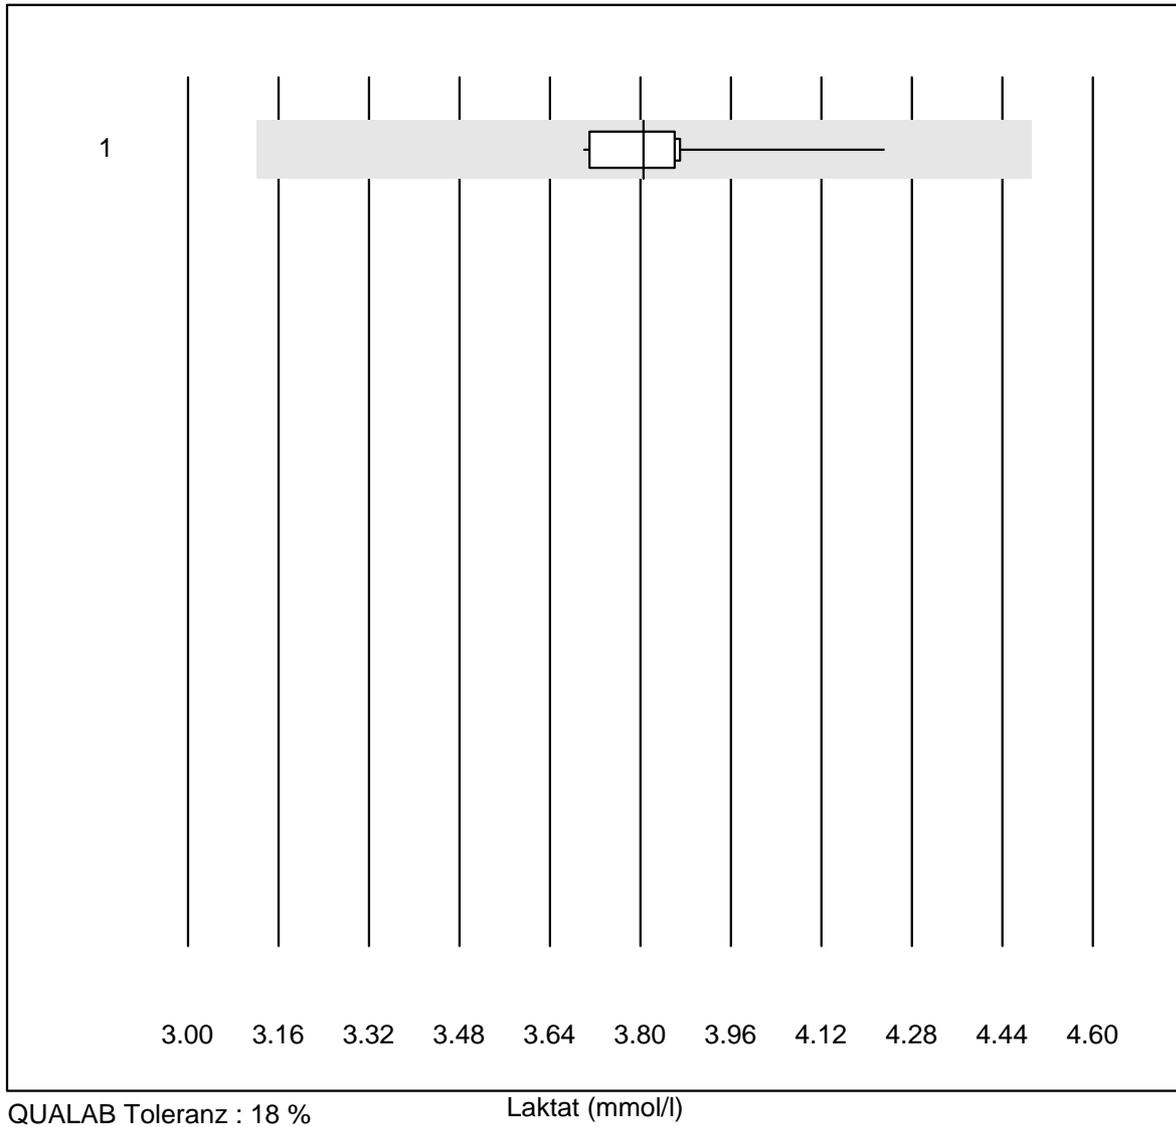


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	12	91.7	0.0	8.3	3.81	4.0	e

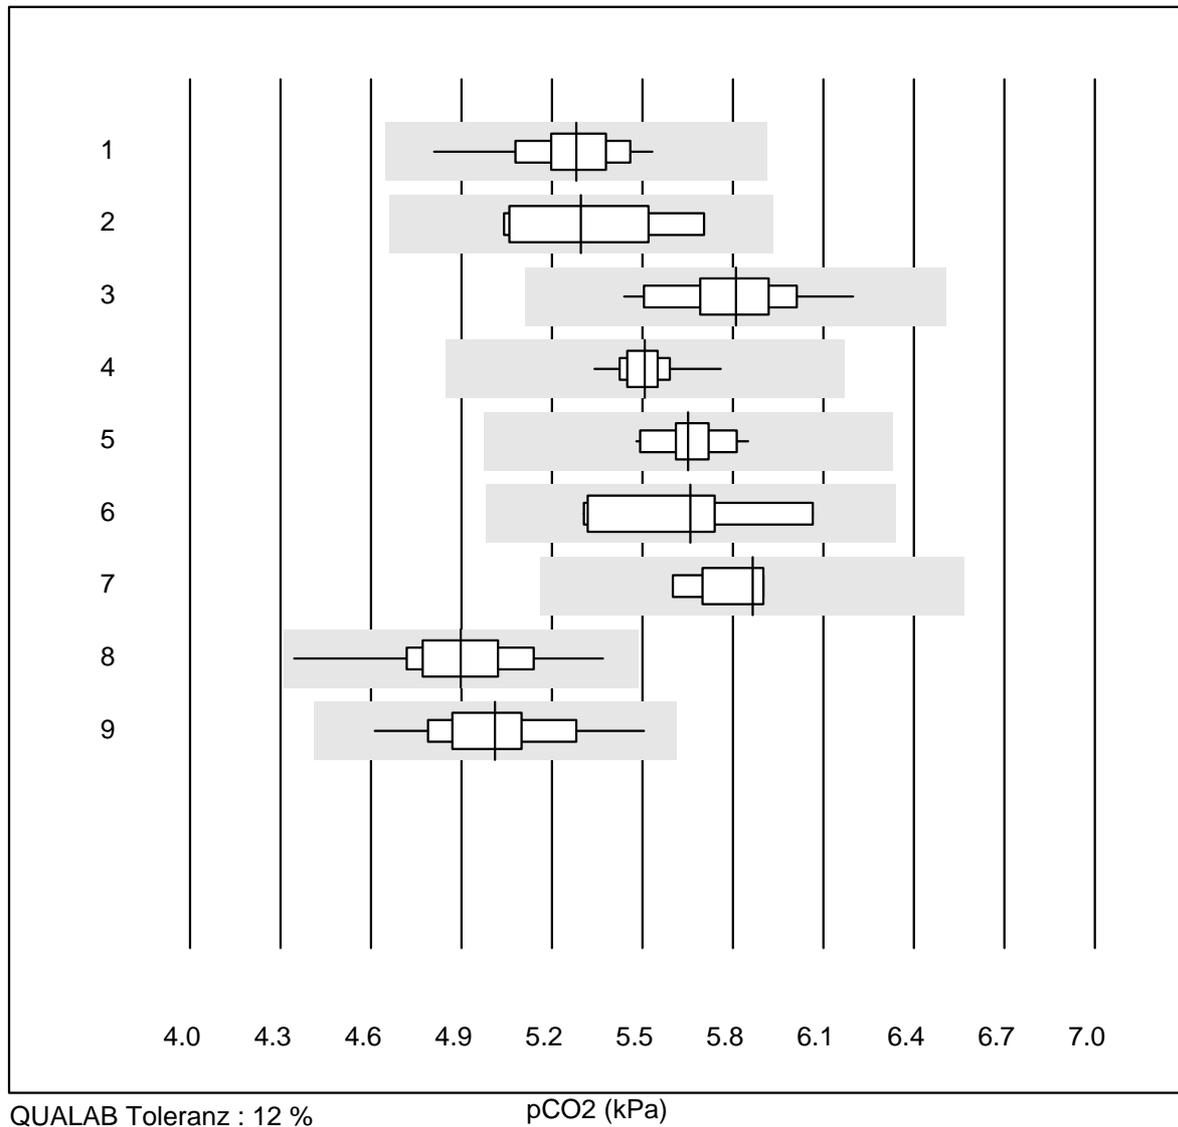pCO₂


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL700/800	80	100.0	0.0	0.0	5.28	2.9	e
2	ABL80 FLEX	8	100.0	0.0	0.0	5.30	4.5	e*
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	15	100.0	0.0	0.0	5.81	3.4	e
4	ABL90 FLEX / PLUS	64	100.0	0.0	0.0	5.51	1.4	e
5	Cobas b 123	14	92.9	0.0	7.1	5.65	2.0	e
6	Cobas b 221	6	100.0	0.0	0.0	5.66	5.1	e*
7	GEM	5	100.0	0.0	0.0	5.87	2.3	e
8	iStat	46	100.0	0.0	0.0	4.90	3.8	e
9	EPOC	44	95.5	0.0	4.5	5.01	4.2	e

pO2

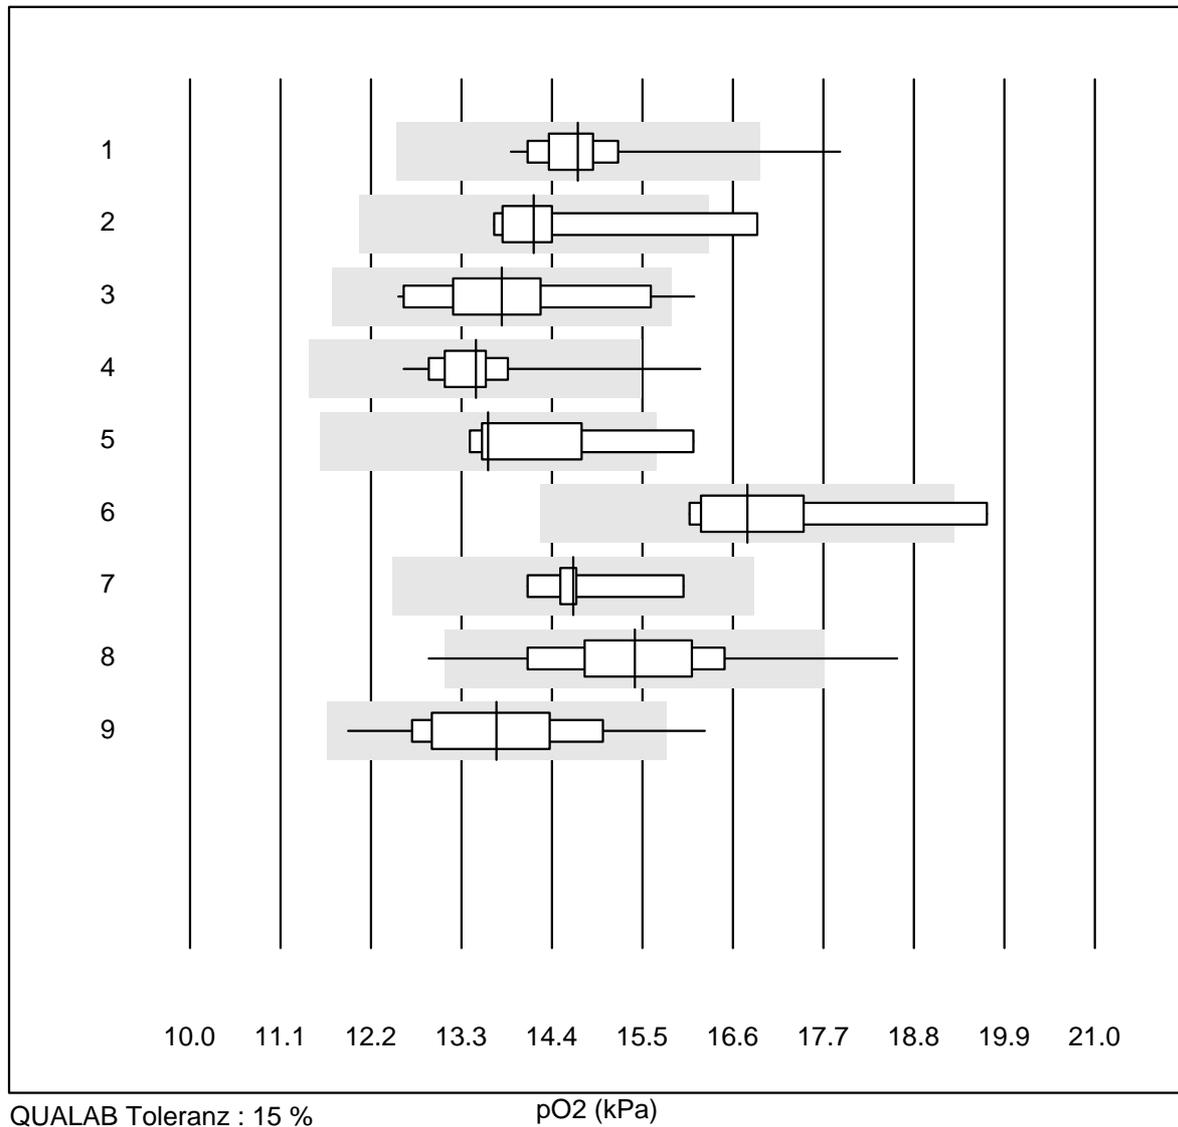

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL700/800	79	95.0	2.5	2.5	14.71	4.6	e
2	ABL80 FLEX	8	87.5	12.5	0.0	14.18	7.2	e*
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	15	93.3	6.7	0.0	13.79	7.2	e*
4	ABL90 FLEX / PLUS	65	95.4	3.1	1.5	13.47	4.5	e
5	Cobas b 123	9	88.9	11.1	0.0	13.62	6.6	e*
6	Cobas b 221	6	83.3	16.7	0.0	16.77	7.8	e*
7	GEM	5	100.0	0.0	0.0	14.66	4.8	e*
8	iStat	45	95.6	4.4	0.0	15.40	6.9	e
9	EPOC	44	90.9	6.8	2.3	13.72	7.2	e

pH

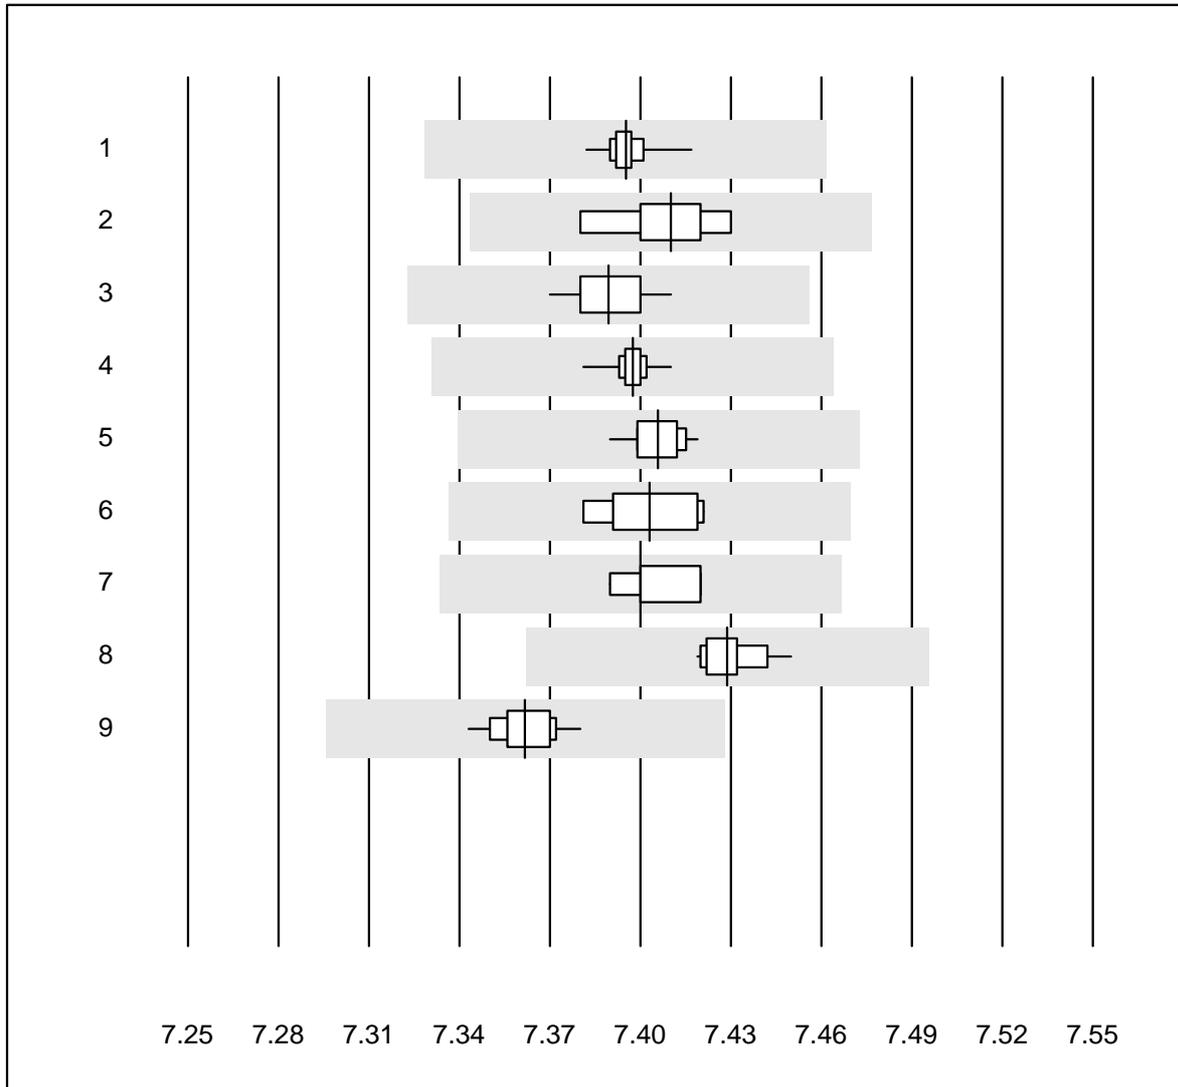


QUALAB Toleranz : 1 %

pH ()


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL700/800	79	100.0	0.0	0.0	7.40	0.1	e
2	ABL80 FLEX	8	100.0	0.0	0.0	7.41	0.2	e
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	15	100.0	0.0	0.0	7.39	0.1	e
4	ABL90 FLEX / PLUS	65	100.0	0.0	0.0	7.40	0.1	e
5	Cobas b 123	13	100.0	0.0	0.0	7.41	0.1	e
6	Cobas b 221	6	100.0	0.0	0.0	7.40	0.2	e
7	GEM	5	100.0	0.0	0.0	7.40	0.2	e
8	iStat	47	100.0	0.0	0.0	7.43	0.1	e
9	EPOC	43	100.0	0.0	0.0	7.36	0.1	e

Glucose GS

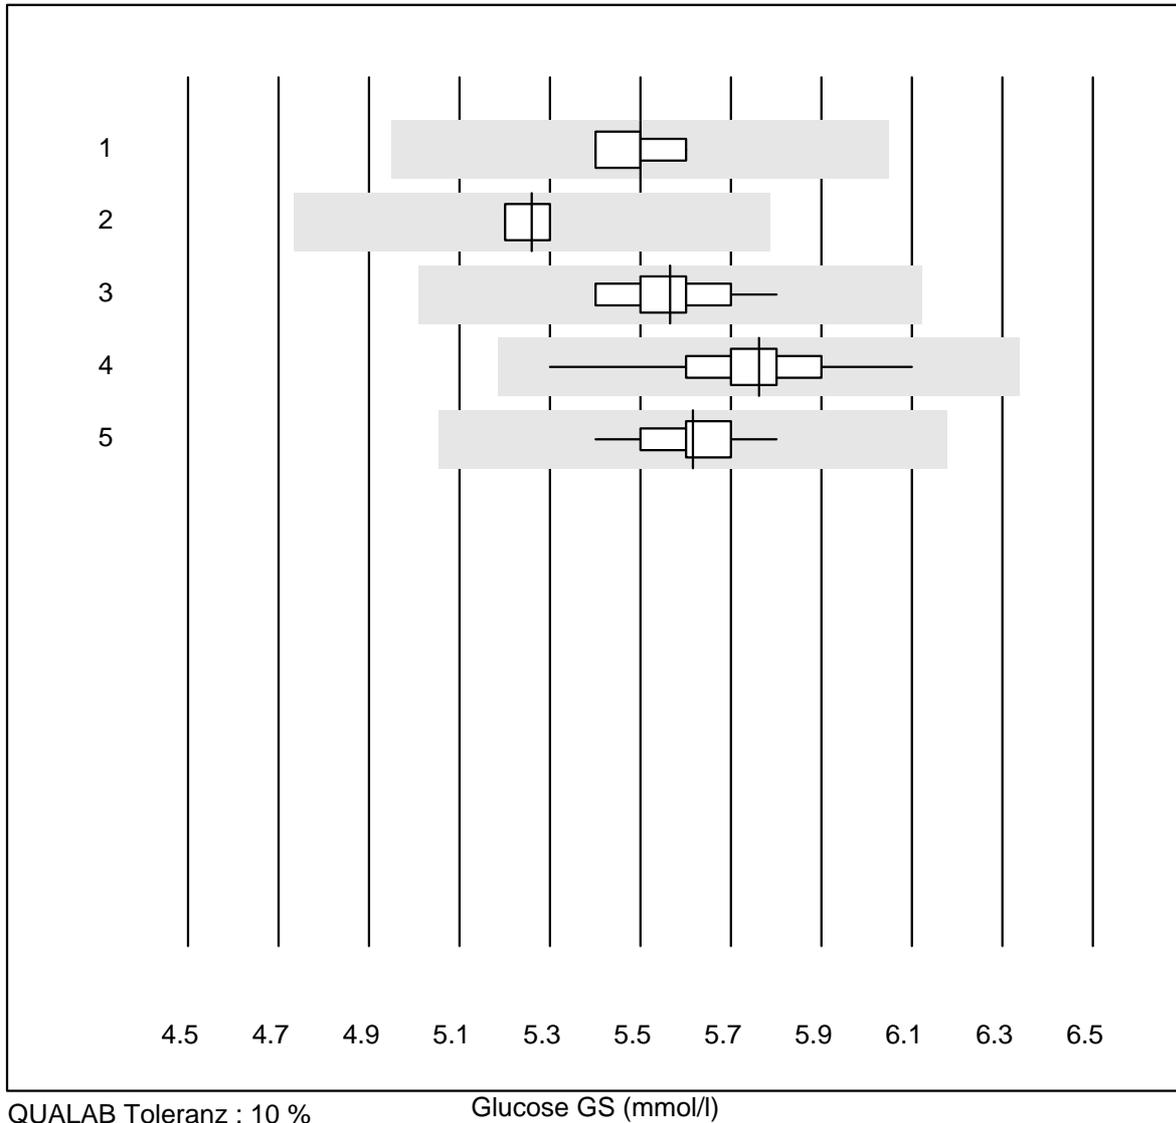


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas b 123	6	100.0	0.0	0.0	5.5	1.4	e
2 iStat	10	100.0	0.0	0.0	5.3	1.0	e
3 EPOC	32	100.0	0.0	0.0	5.6	1.9	e
4 ABL700/800	68	100.0	0.0	0.0	5.8	2.3	e
5 ABL90 FLEX / PLUS	63	100.0	0.0	0.0	5.6	1.6	e

Hémoglobine BG

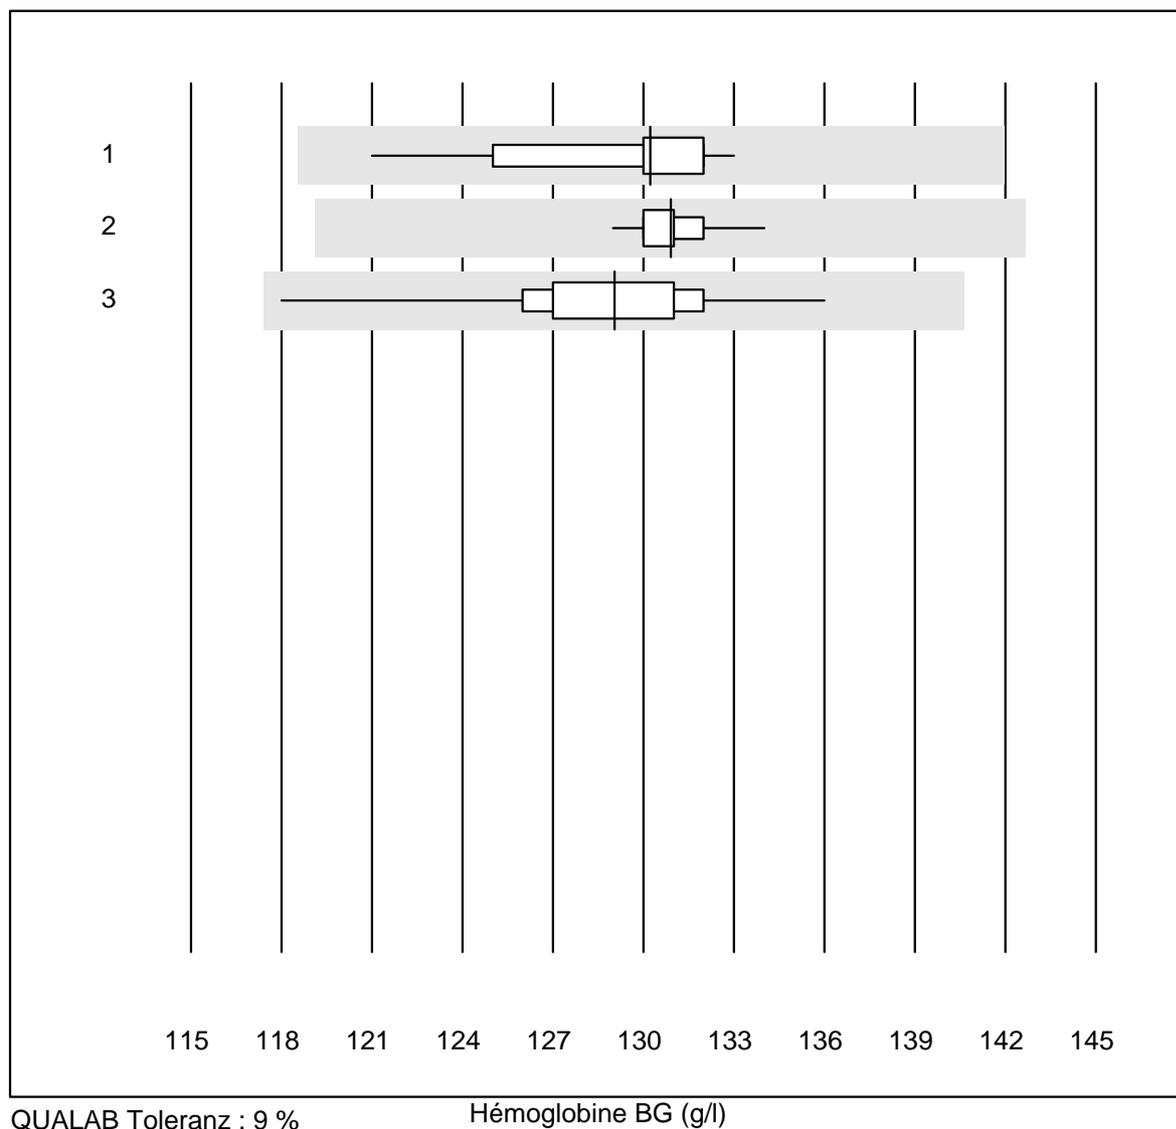

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 ABL700/800	72	98.6	0.0	1.4	130.2	2.2	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	63	98.4	0.0	1.6	130.9	0.6	e
3 ABL80 FLEX CO-OX / O	12	100.0	0.0	0.0	129.0	3.3	e

Potassium BG

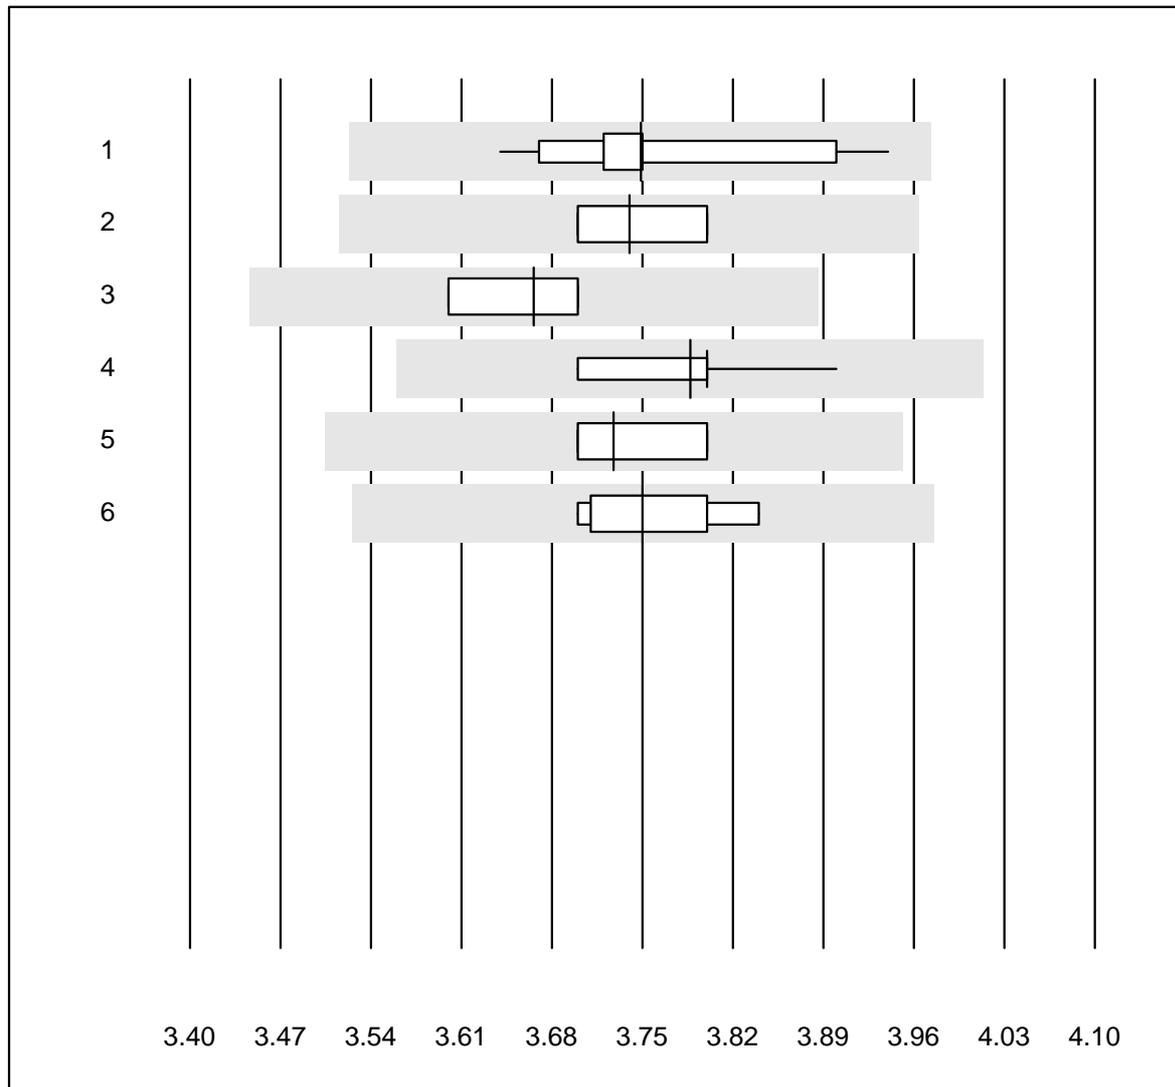


QUALAB Toleranz : 6 %

Potassium BG (mmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas b 123	18	94.4	0.0	5.6	3.7	1.9	e
2	iStat	20	100.0	0.0	0.0	3.7	1.3	e
3	EPOC	38	100.0	0.0	0.0	3.7	1.3	e
4	ABL700/800	71	98.6	0.0	1.4	3.8	1.1	e
5	ABL90 FLEX / PLUS	65	100.0	0.0	0.0	3.7	1.2	e
6	ABL80 FLEX CO-OX / O	7	100.0	0.0	0.0	3.8	1.3	e

Sodium BG

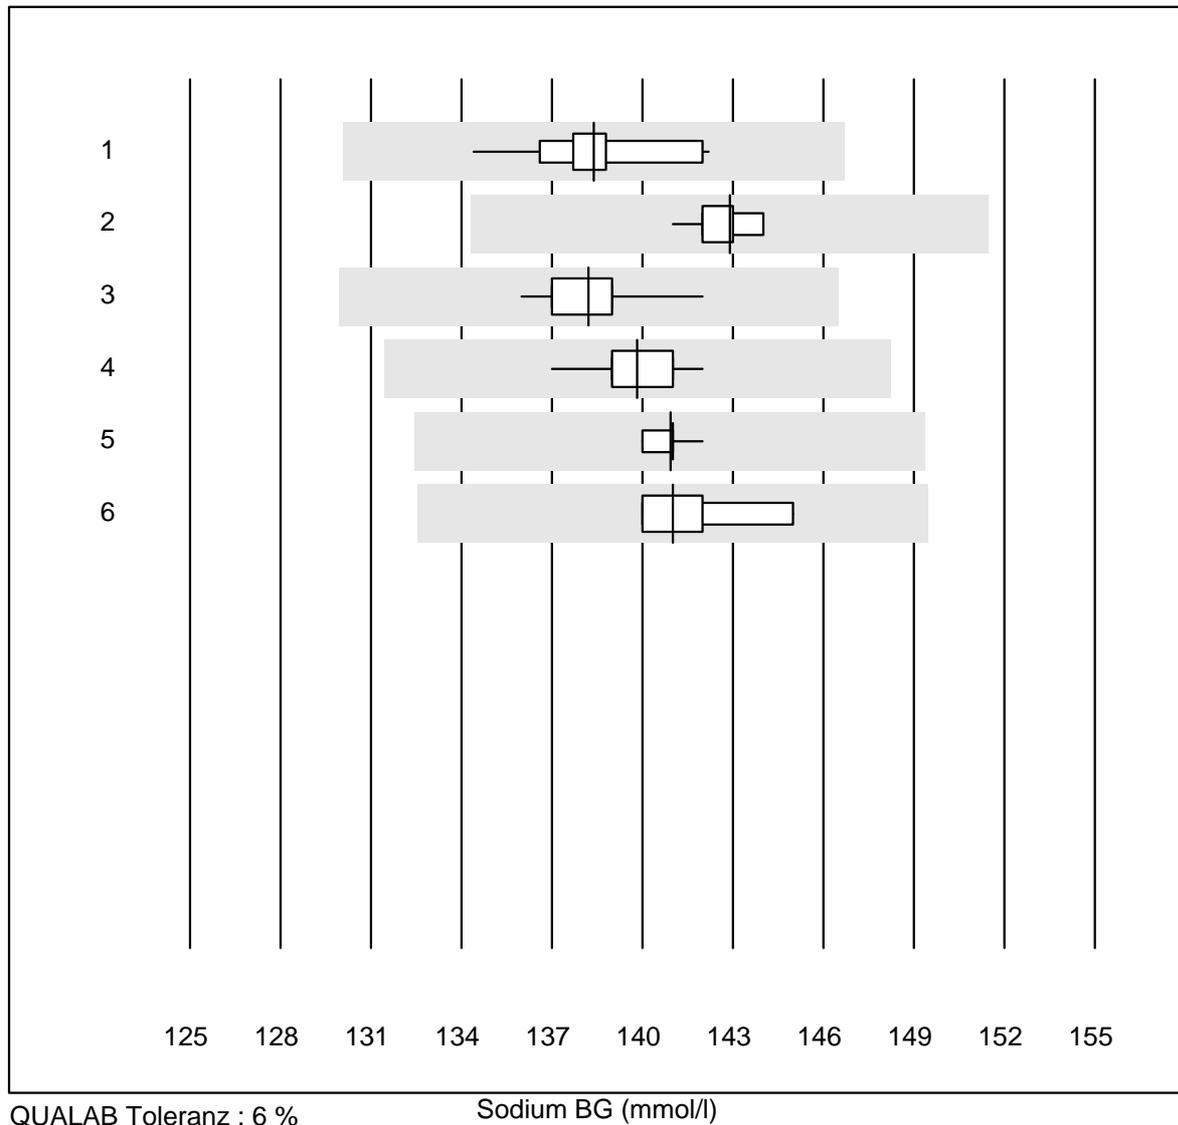

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas b 123	18	94.4	0.0	5.6	138.4	1.4	e
2	iStat	20	100.0	0.0	0.0	142.9	0.6	e
3	EPOC	36	100.0	0.0	0.0	138.2	0.9	e
4	ABL700/800	69	100.0	0.0	0.0	139.8	0.7	e
5	ABL90 FLEX / PLUS	64	100.0	0.0	0.0	140.9	0.3	e
6	ABL80 FLEX CO-OX / O	7	100.0	0.0	0.0	141.0	1.3	e

Chlorure-BG

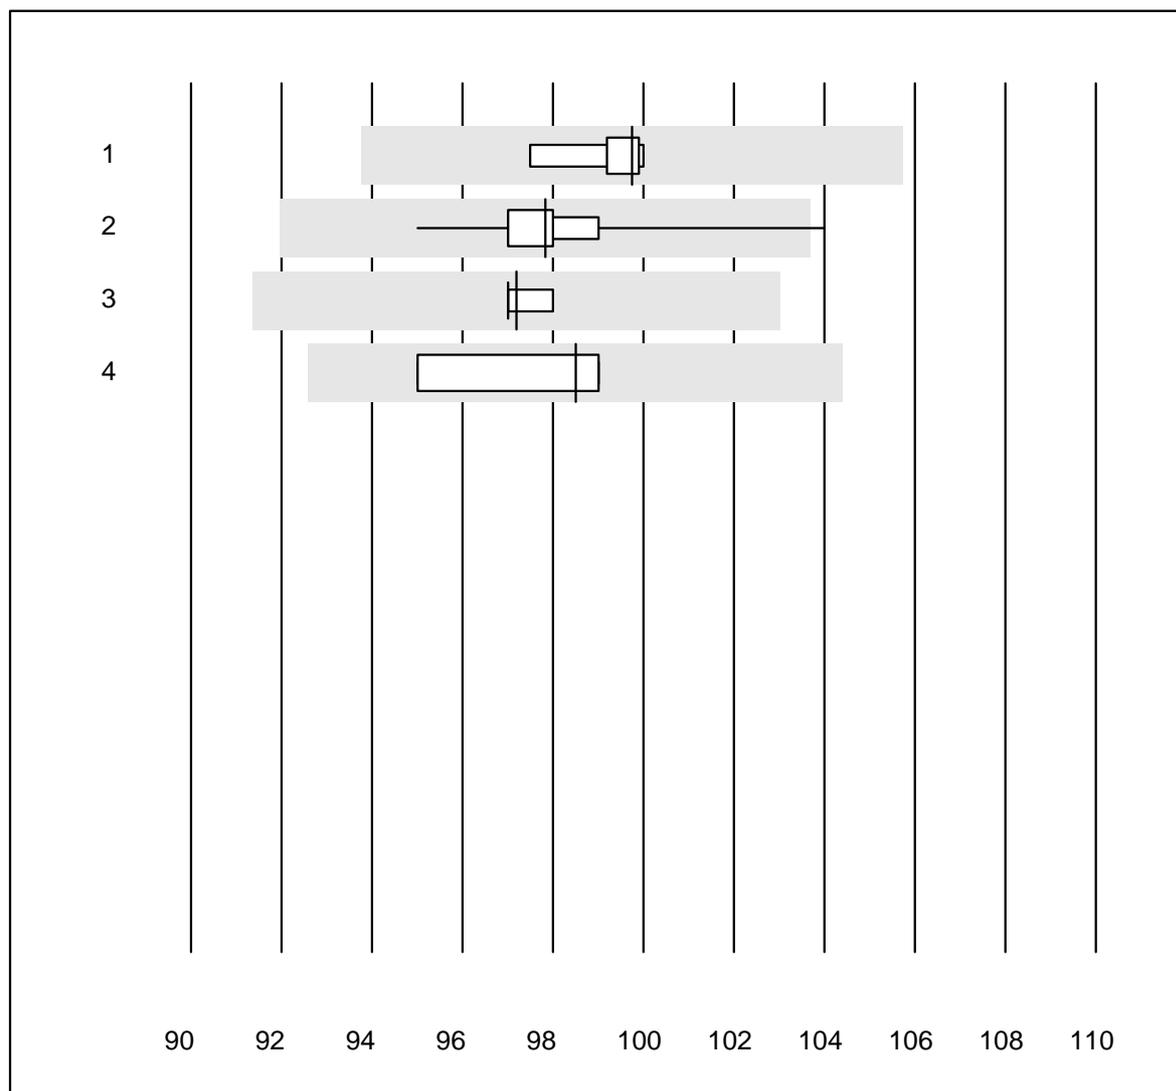


QUALAB Toleranz : 6 %

Chlorure-BG (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas b 123	6	100.0	0.0	0.0	99.8	1.0	e
2 ABL700/800	65	98.5	1.5	0.0	97.8	1.3	e
3 ABL90 FLEX / PLUS	63	100.0	0.0	0.0	97.2	0.4	e
4 ABL80 FLEX CO-OX / O	4	100.0	0.0	0.0	98.5	1.9	e*

Calcium-BG

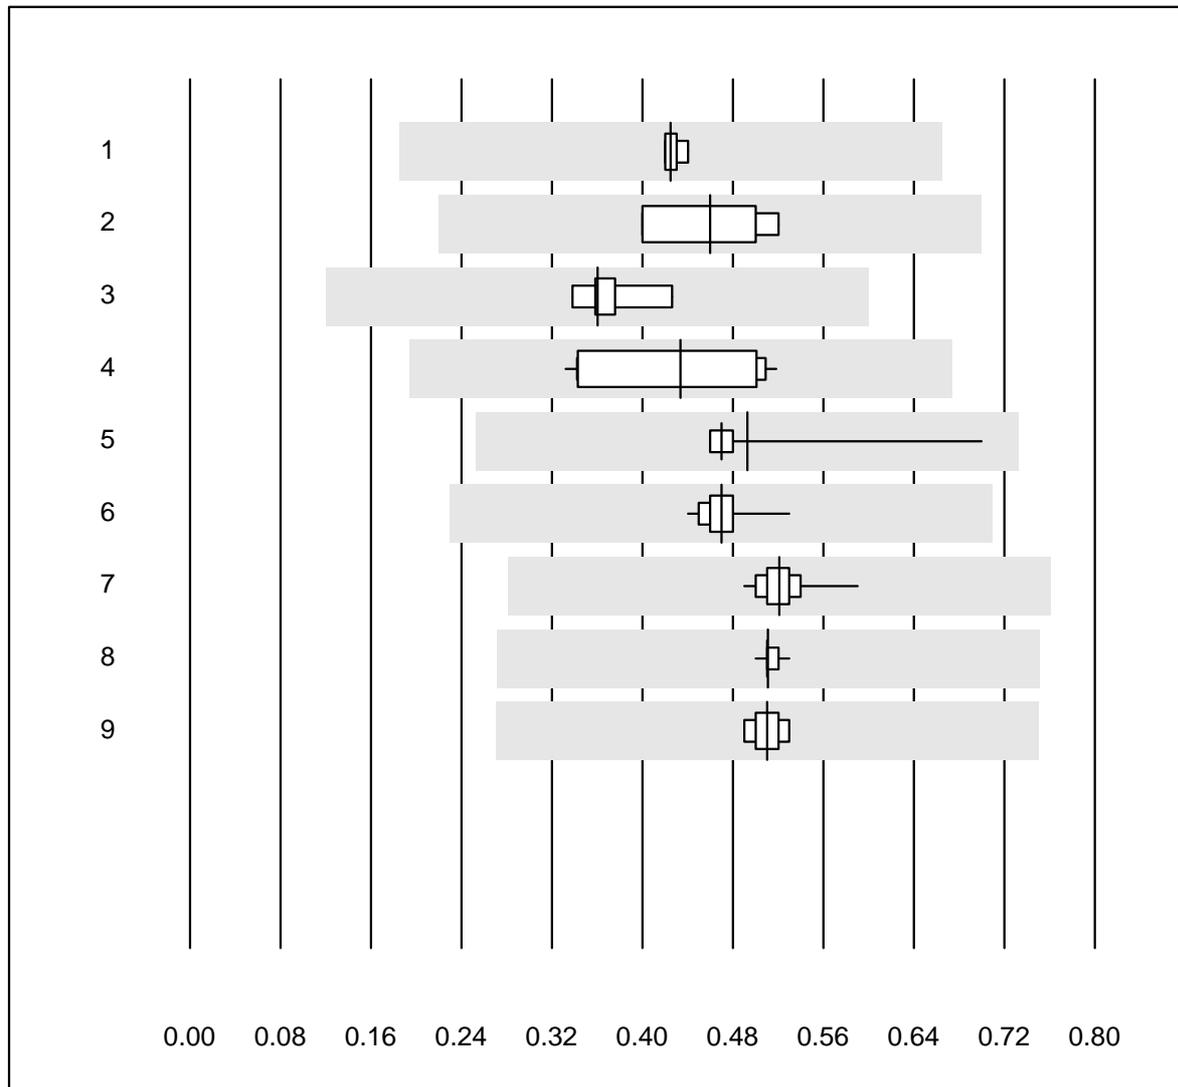


Tolérance MQ : 12 %
(< 2.00: +/- 0.24 mmol/l)

Calcium-BG (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 GEM	4	100.0	0.0	0.0	0.43	2.2	e
2 ABL80 FLEX	4	100.0	0.0	0.0	0.46	12.8	e*
3 Cobas b123	5	100.0	0.0	0.0	0.36	9.0	e*
4 Cobas	12	100.0	0.0	0.0	0.43	16.9	e*
5 iStat	10	100.0	0.0	0.0	0.49	14.8	e*
6 EPOC	34	100.0	0.0	0.0	0.47	3.5	e
7 ABL700/800	70	100.0	0.0	0.0	0.52	3.3	e
8 ABL90 FLEX / PLUS	65	100.0	0.0	0.0	0.51	1.0	e
9 ABL80 FLEX CO-OX / O	6	100.0	0.0	0.0	0.51	3.0	e

FHHb

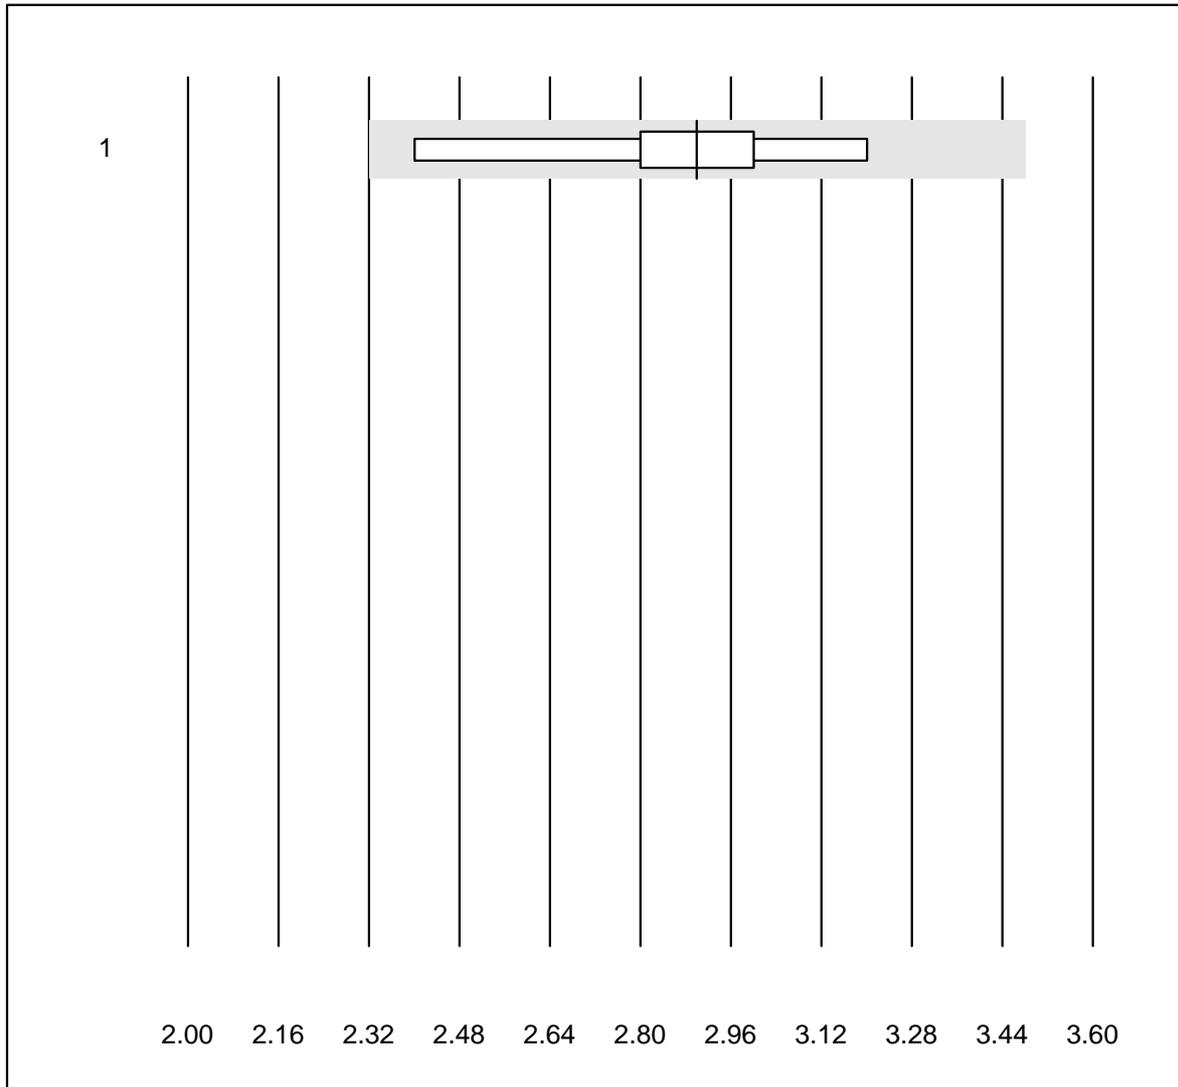


Tolérance MQ : 20 %

FHHb (%)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL80 FLEX CO-OX / O	7	100.0	0.0	0.0	2.900	8.6	e*

Lactate-BG

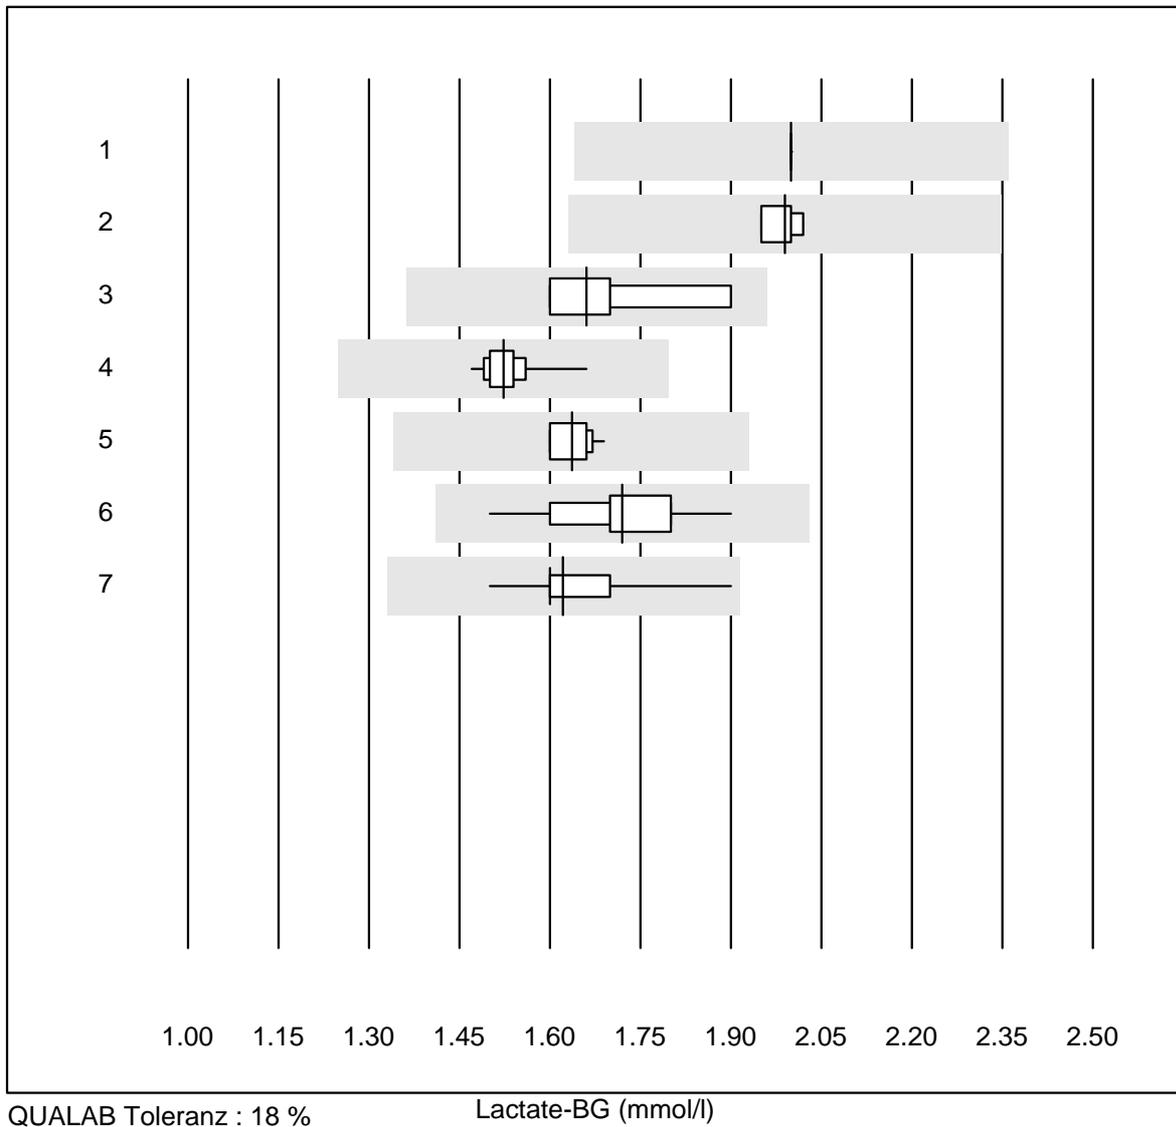


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas b123	4	100.0	0.0	0.0	2.00	0.0	e
2	Cobas	4	100.0	0.0	0.0	1.99	1.5	e
3	IL	4	100.0	0.0	0.0	1.66	8.0	e*
4	EPOC	39	100.0	0.0	0.0	1.52	2.4	e
5	iStat	13	100.0	0.0	0.0	1.64	1.9	e
6	ABL700/800	75	100.0	0.0	0.0	1.72	4.1	e
7	ABL90 FLEX / PLUS	65	100.0	0.0	0.0	1.62	3.5	e

sO2 OR

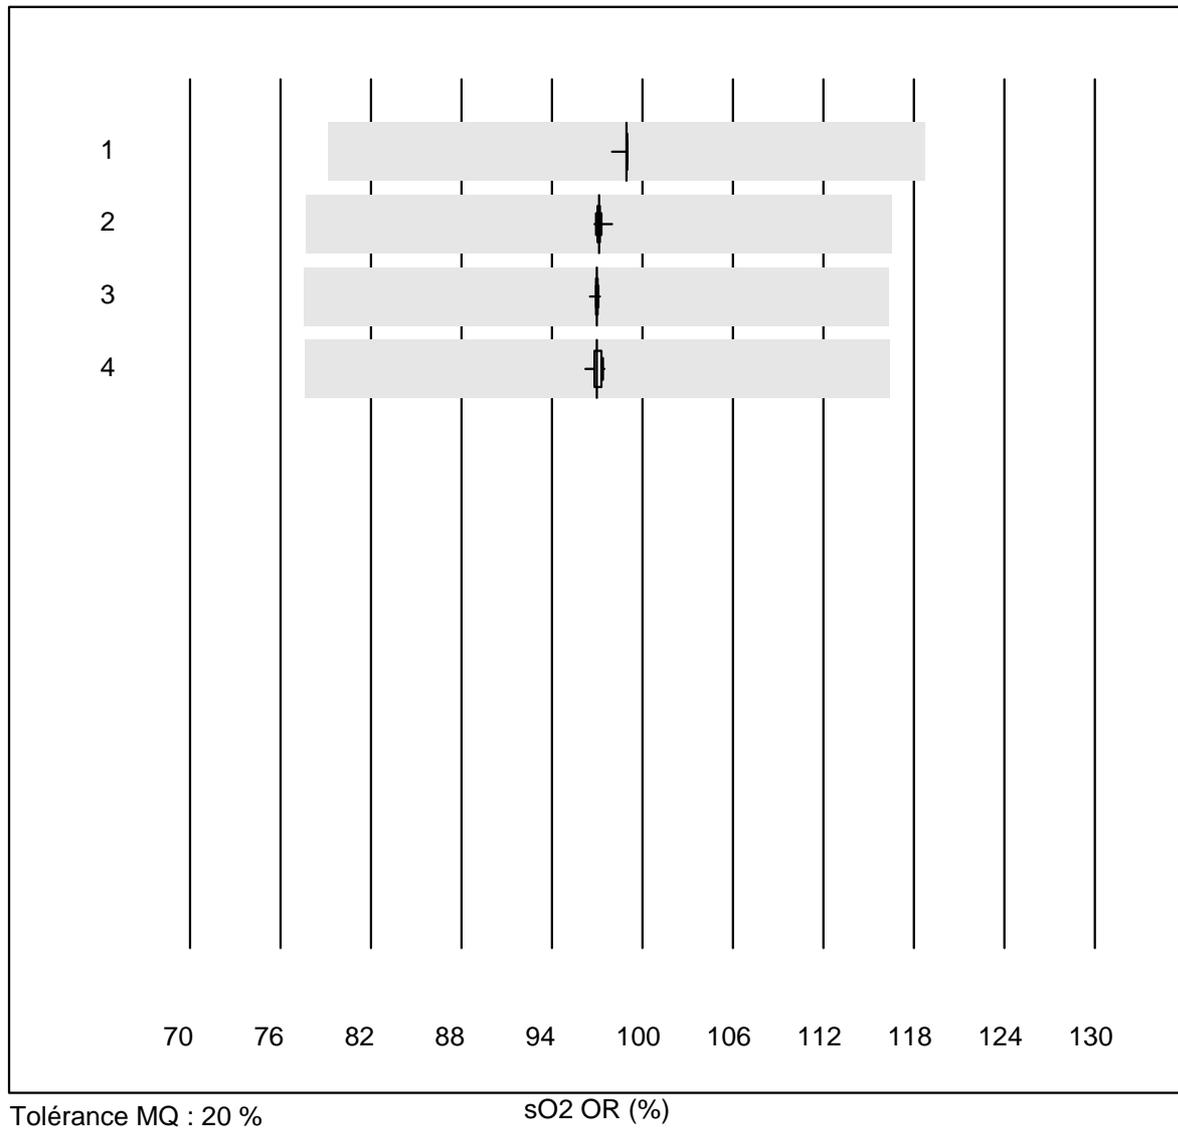


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	iStat	13	100.0	0.0	0.0	98.923	0.3	e
2	ABL700/800	51	100.0	0.0	0.0	97.128	0.2	e
3	ABL90 FLEX / PLUS	56	100.0	0.0	0.0	96.964	0.1	e
4	ABL80 FLEX CO-OX / O	11	100.0	0.0	0.0	96.991	0.4	e

FO2Hb OR

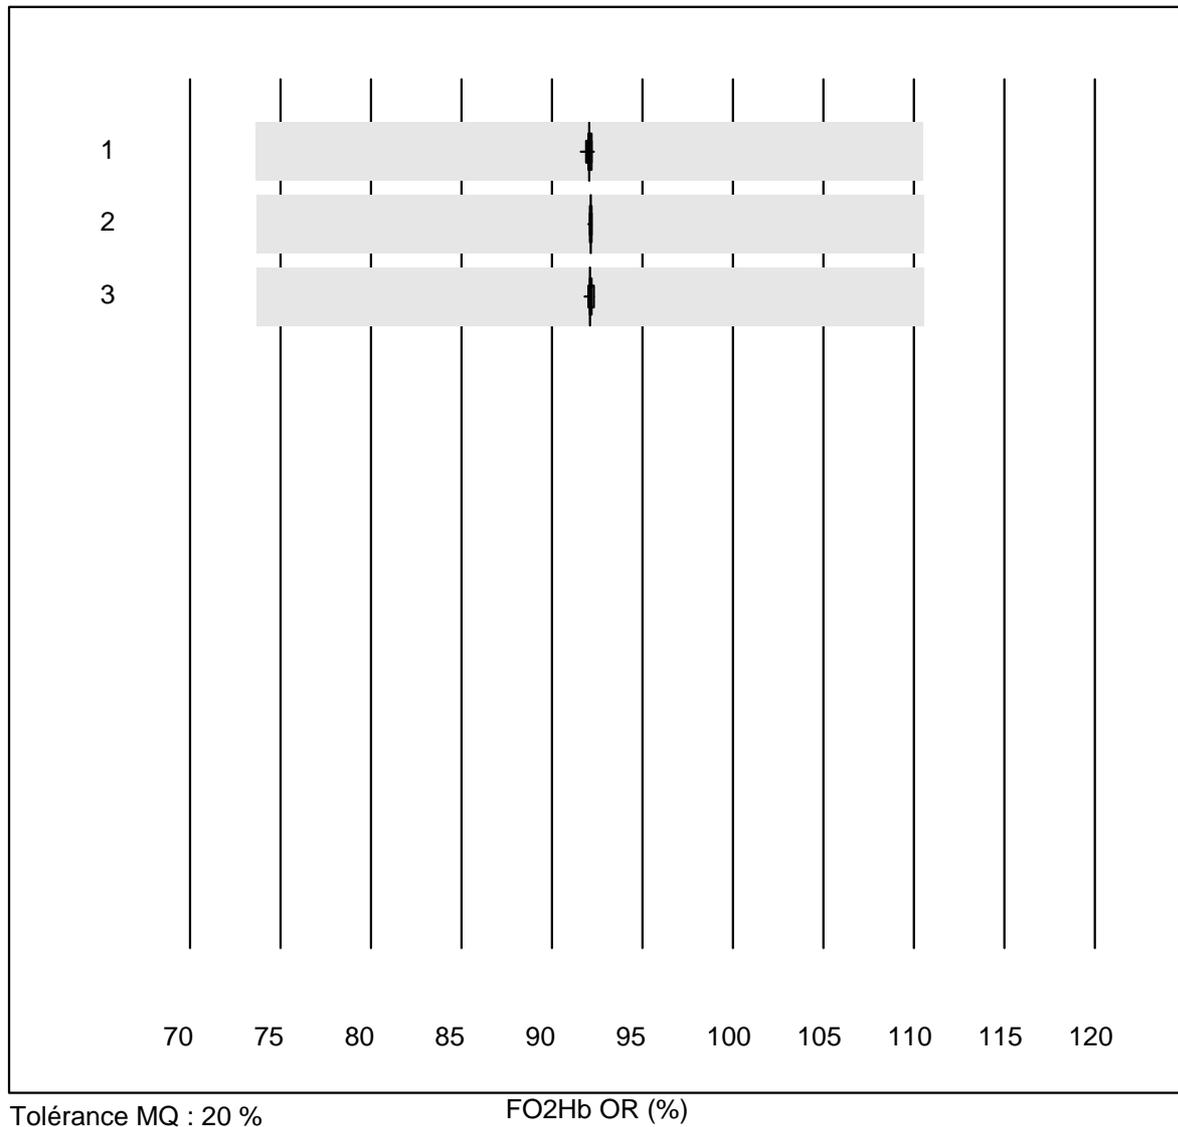

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL700/800	50	100.0	0.0	0.0	92.078	0.2	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	55	100.0	0.0	0.0	92.147	0.1	e
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	14	100.0	0.0	0.0	92.121	0.1	e

FCOHb OR

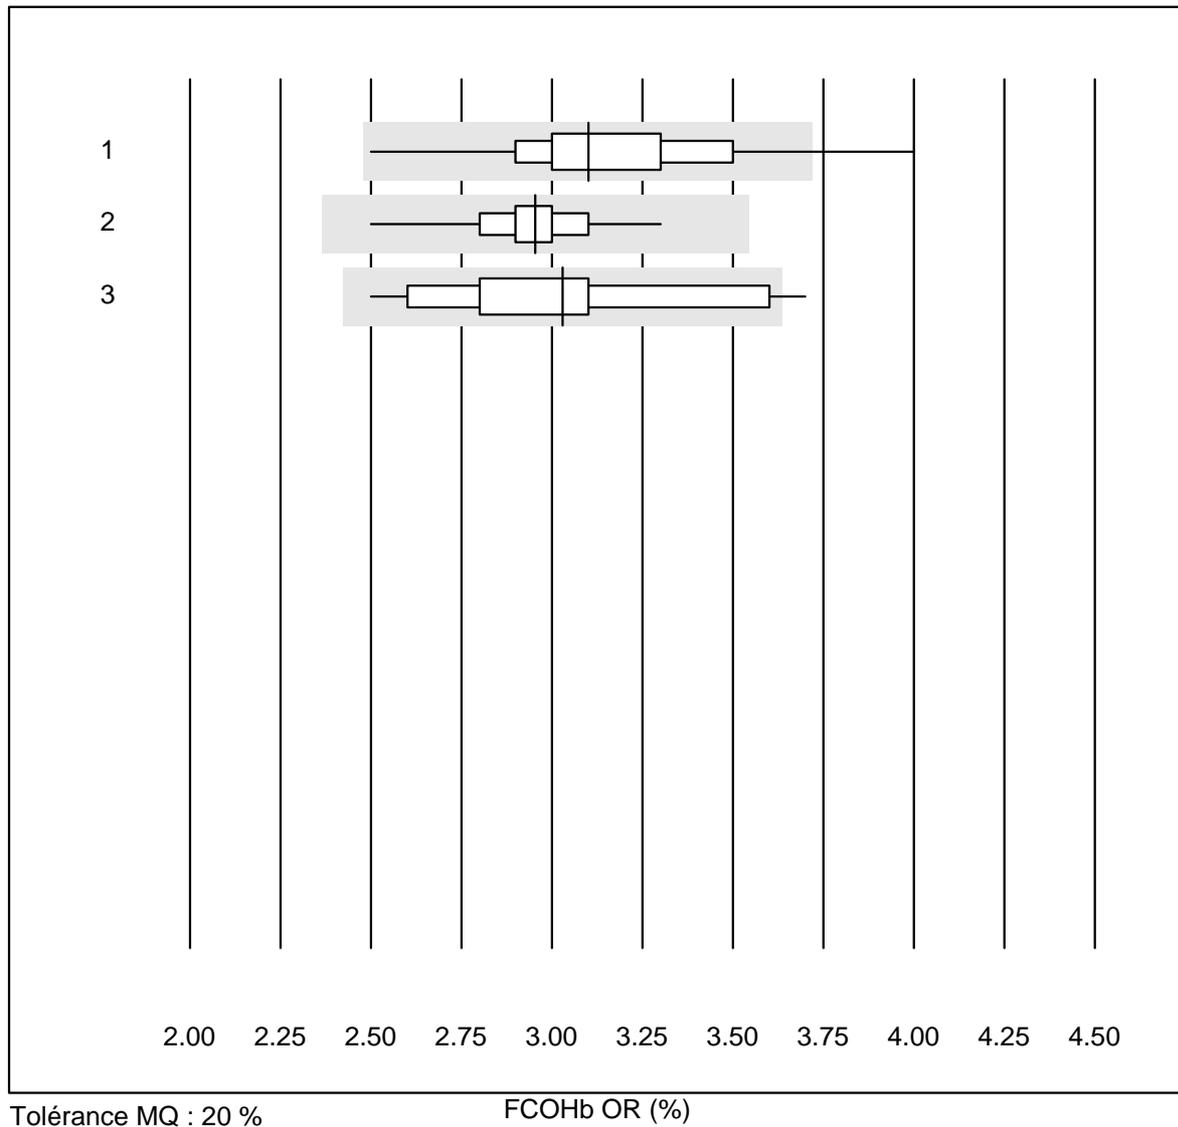


Tolérance MQ : 20 %

FCOHb OR (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL700/800	52	96.2	3.8	0.0	3.100	8.8	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	54	100.0	0.0	0.0	2.954	4.9	e
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	14	92.9	7.1	0.0	3.029	11.6	e*

FMetHb OR

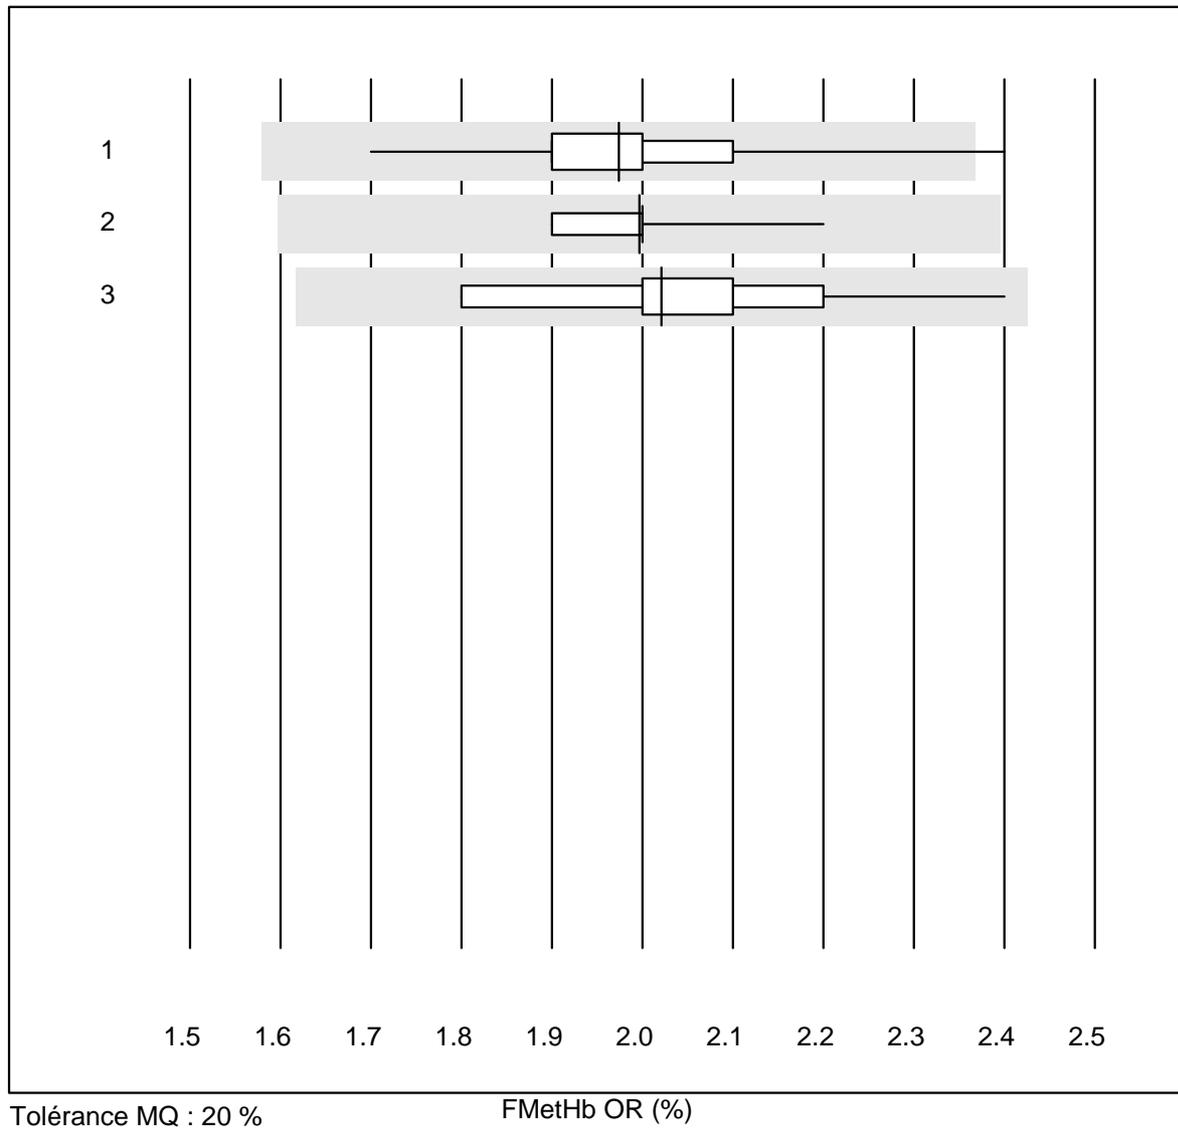


Tolérance MQ : 20 %

FMetHb OR (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL700/800	54	96.2	1.9	1.9	1.974	6.1	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	54	100.0	0.0	0.0	1.996	2.4	e
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	14	100.0	0.0	0.0	2.021	8.0	e

FHbF OR

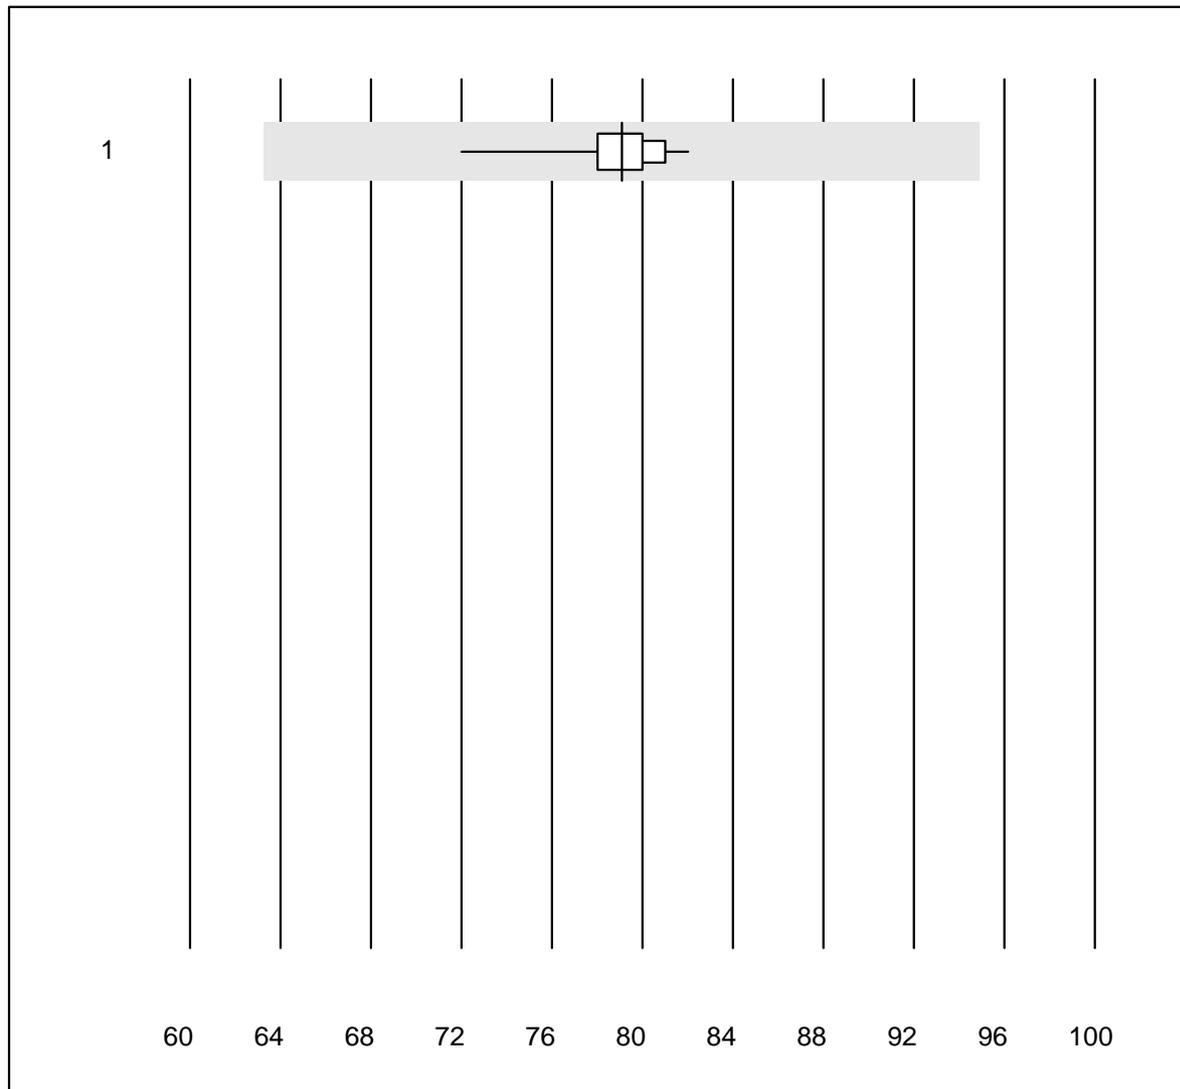


Tolérance MQ : 20 %

FHbF OR (%)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 ABL90 FLEX / PLUS	13	92.3	0.0	7.7	79.083	3.2	e

Bilirubin OR

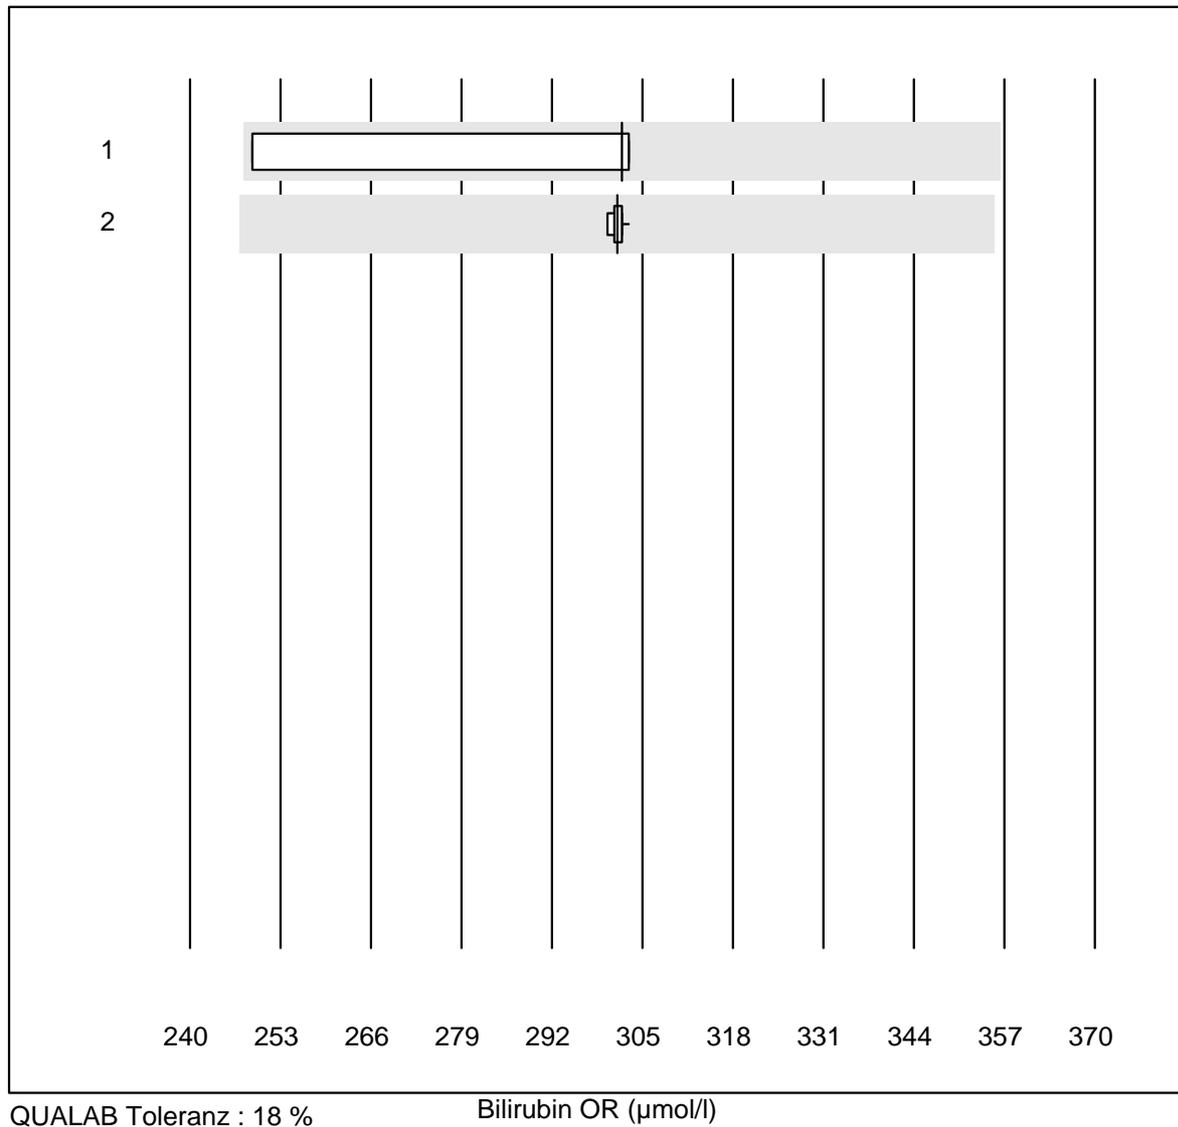

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL700/800	4	100.0	0.0	0.0	302.0	9.2	e*
2	ABL90 FLEX / PLUS	19	100.0	0.0	0.0	301.4	0.3	e

Troponine I

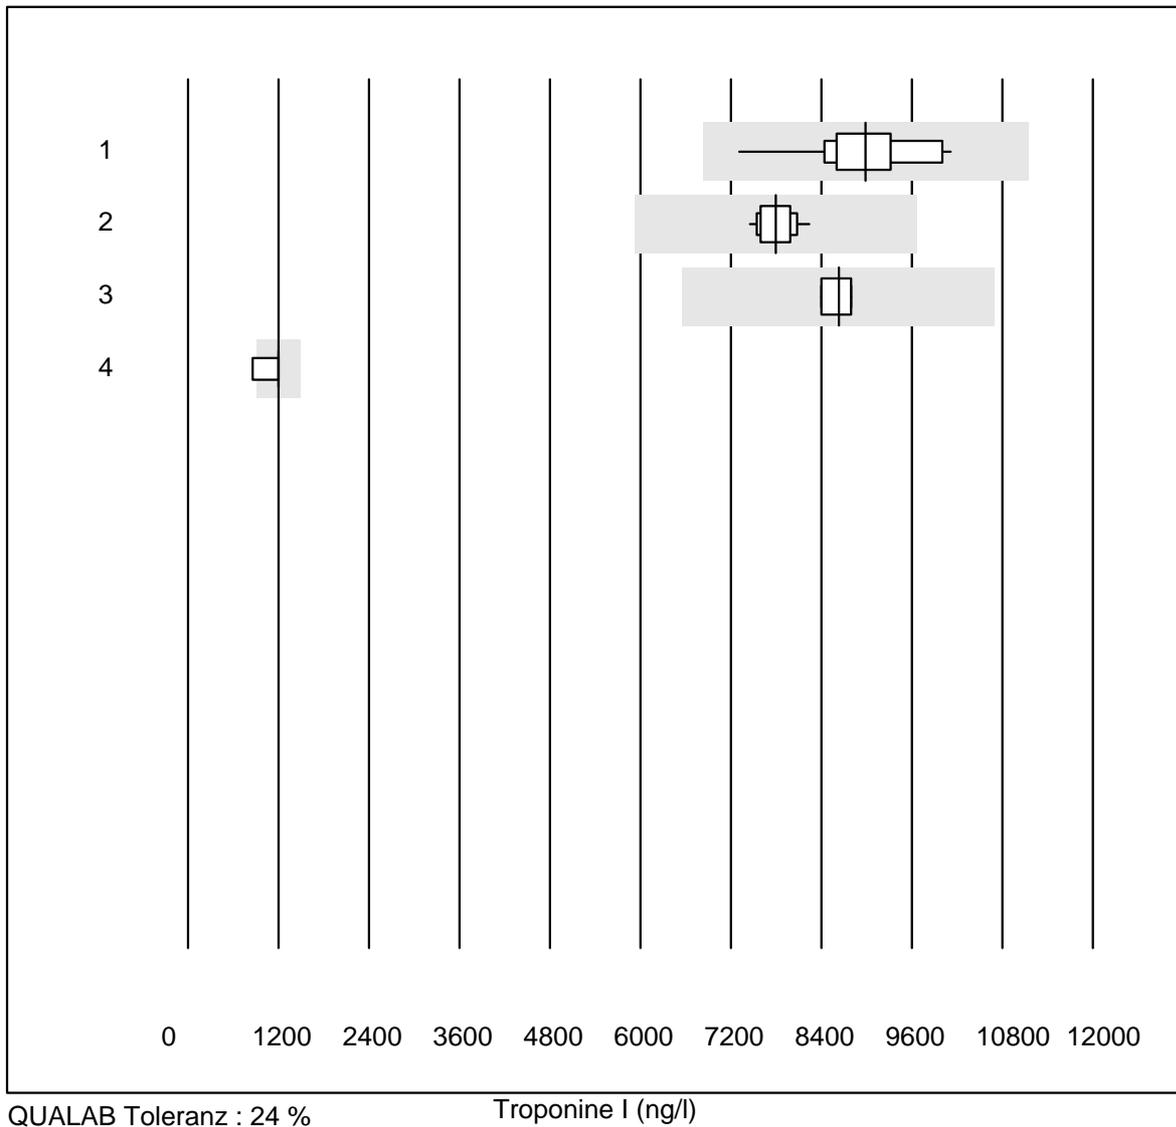


QUALAB Toleranz : 24 %

Troponine I (ng/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Vidas	14	92.9	0.0	7.1	8986.4	8.6	e
2 Architect High Sensi	11	100.0	0.0	0.0	7795.8	3.3	e
3 Autres méthodes	4	75.0	0.0	25.0	8630.0	2.3	e
4 AQT 90 FLEX	6	66.6	16.7	16.7	1200.0	13.4	e*

Troponine T

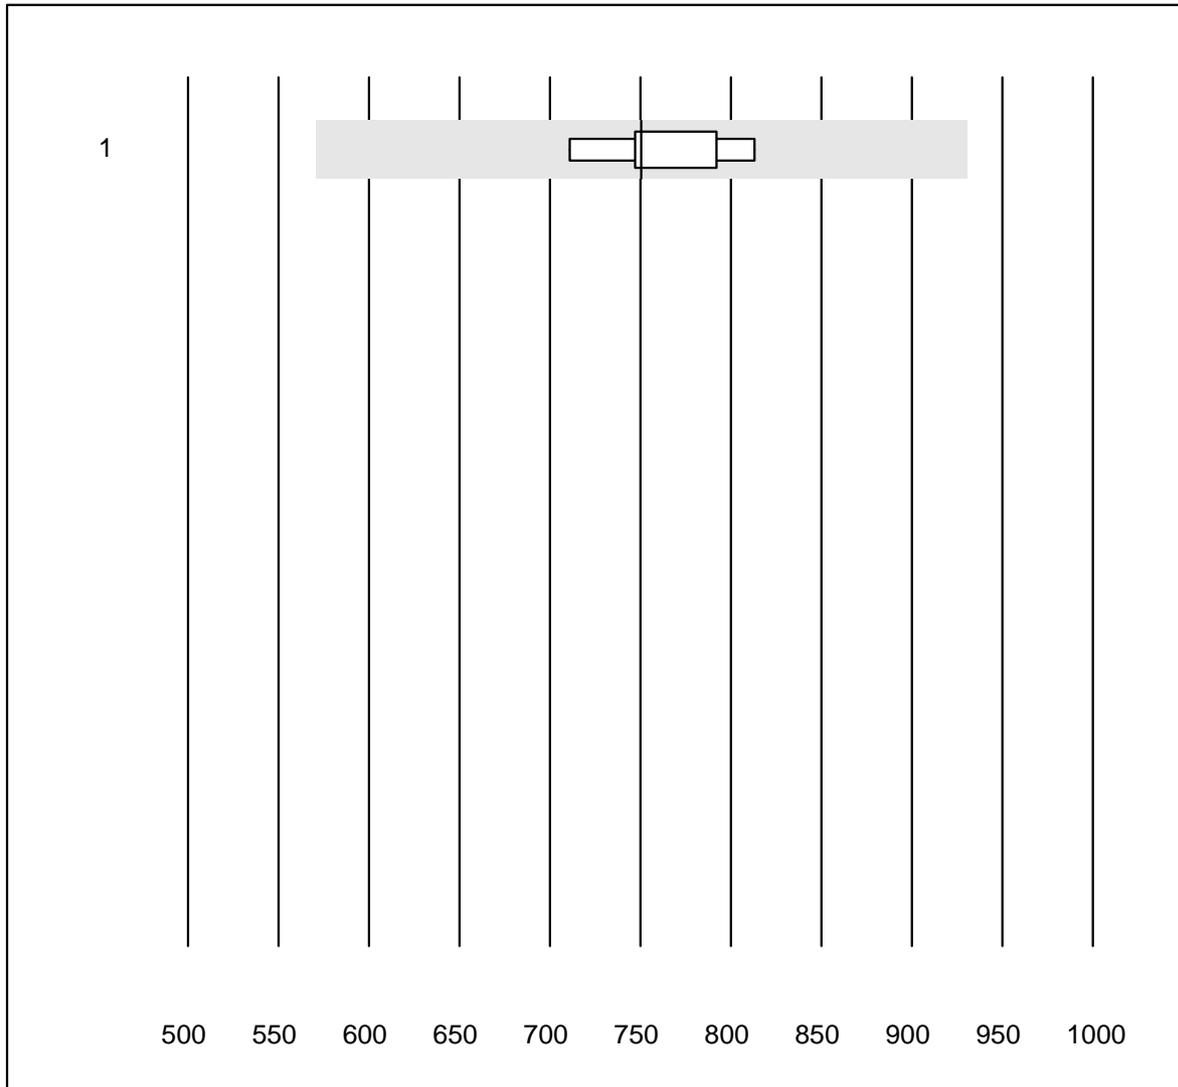


QUALAB Toleranz : 24 %

Troponine T (ng/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas hs STAT	9	100.0	0.0	0.0	750.60	4.3	e

Myoglobine

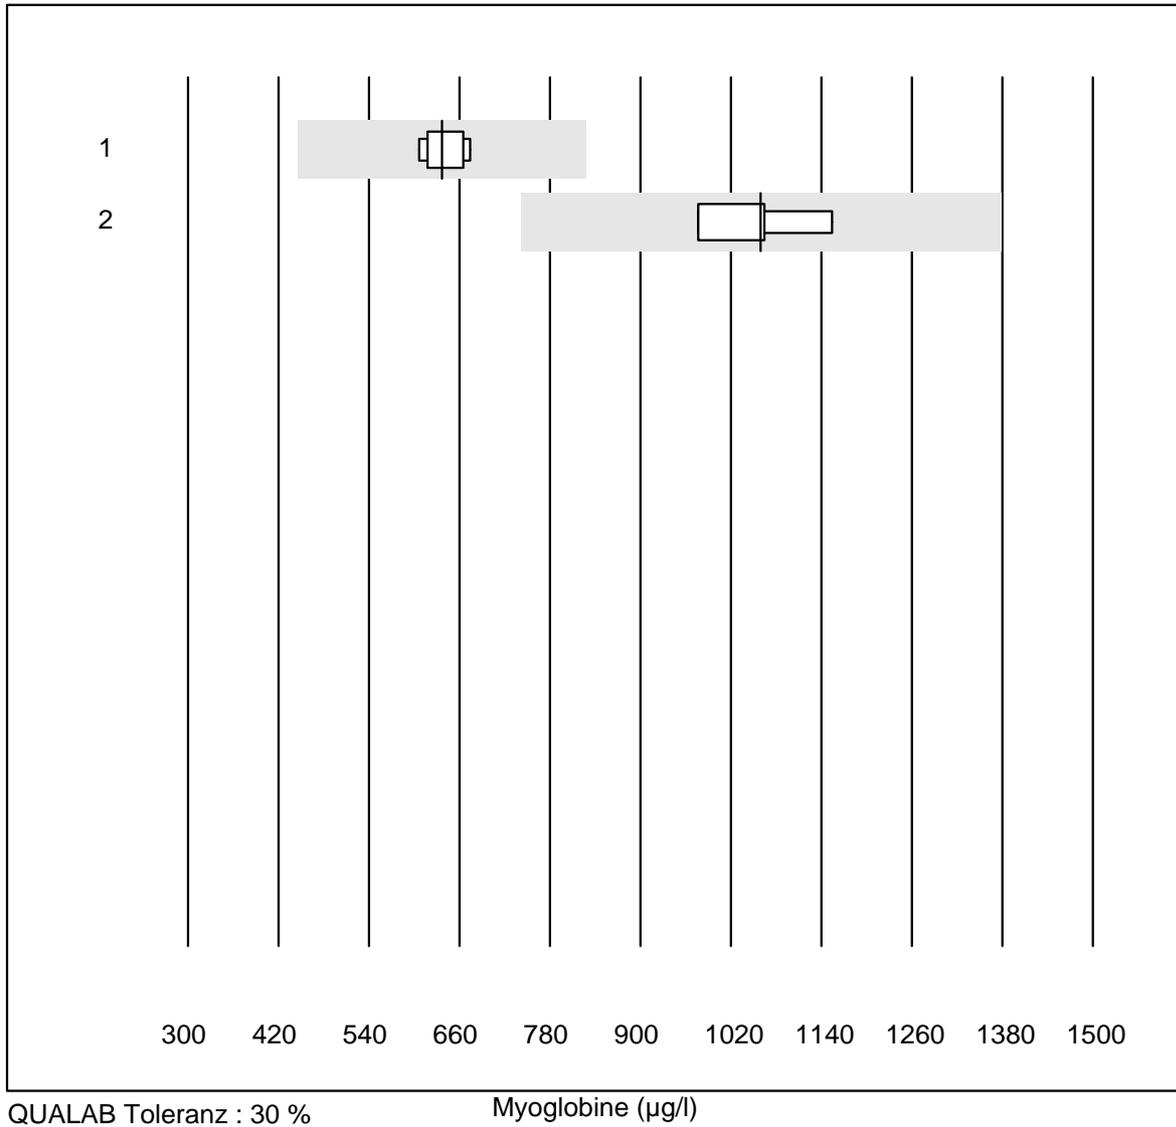


QUALAB Toleranz : 30 %

Myoglobine (µg/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	5	100.0	0.0	0.0	637.0	4.5	e
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	1059.7	6.8	e

masse CK-MB

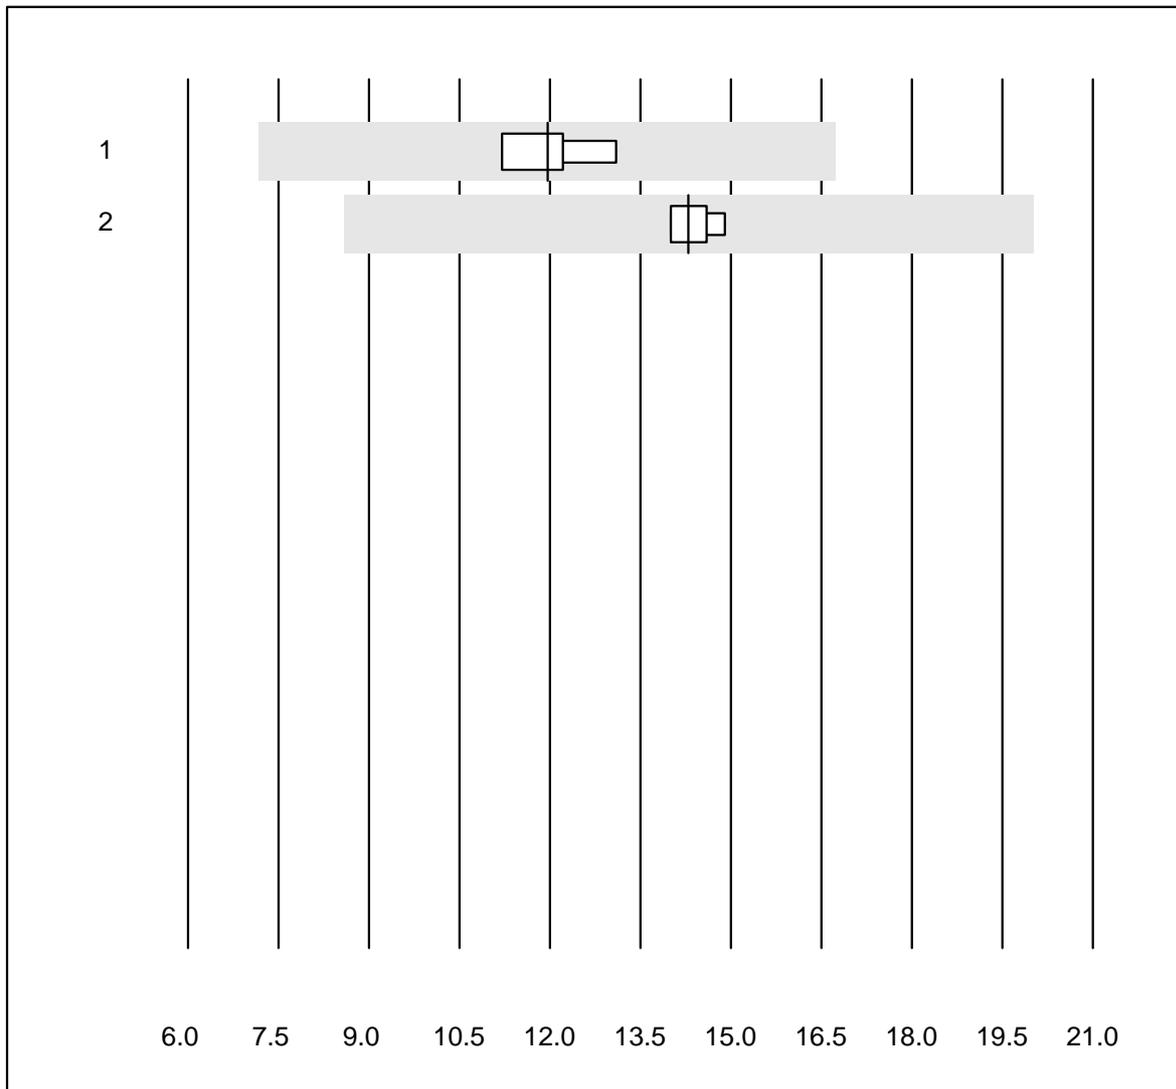


Tolérance MQ : 40 %

masse CK-MB (µg/l)

Nr. Methode	Total	% Efulft	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Architect	4	100.0	0.0	0.0	12.0	6.7	e
2 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	14.3	3.1	e

NT-proBNP

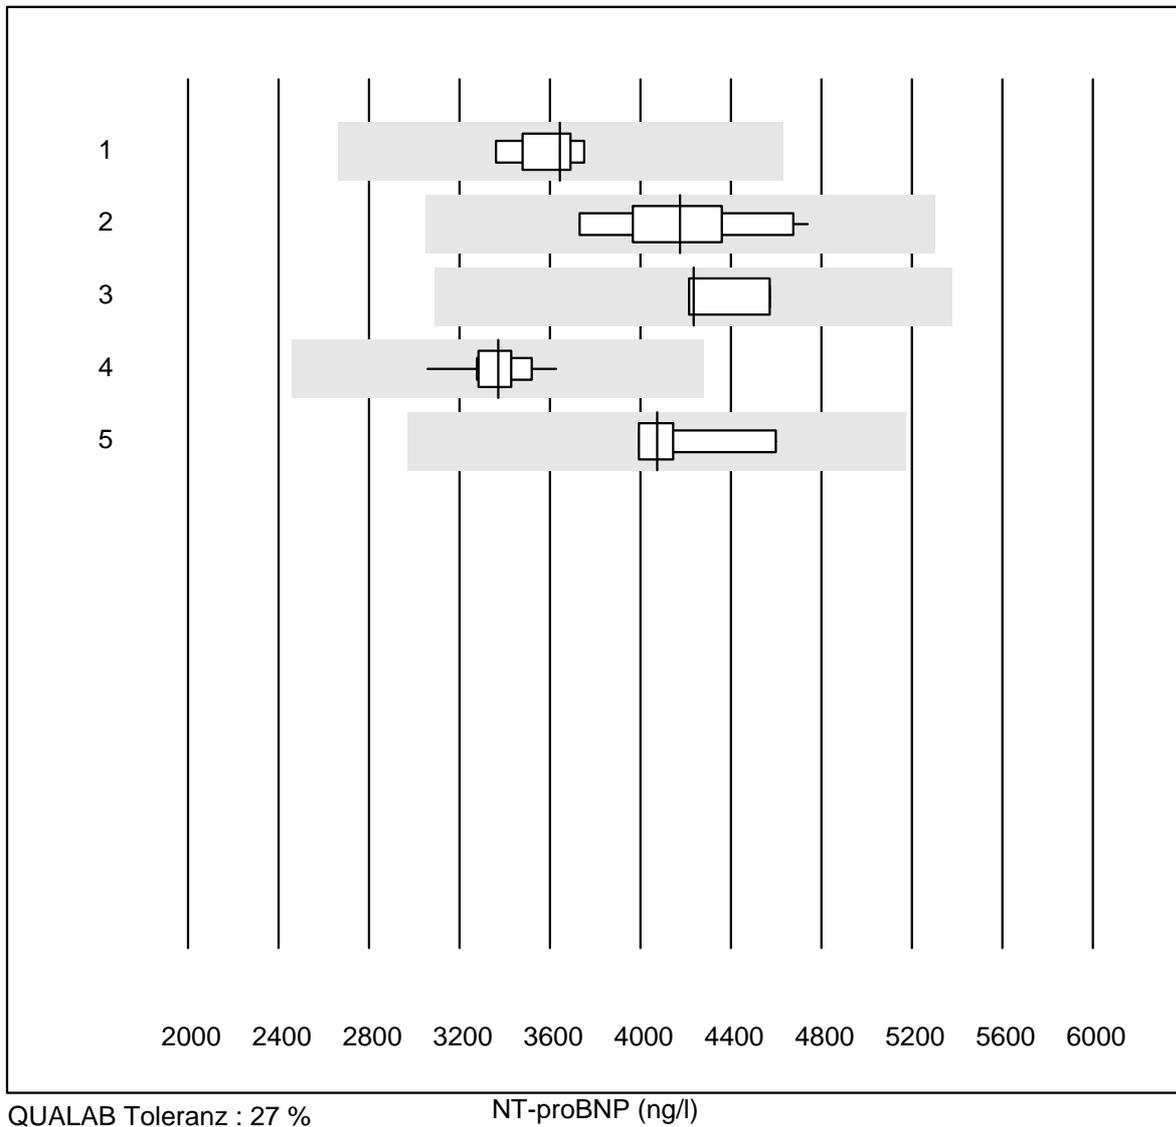


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 AQT 90 FLEX	6	100.0	0.0	0.0	3645.0	4.1	e
2 VIDAS	10	100.0	0.0	0.0	4175.2	7.8	e
3 Autres méthodes	4	75.0	0.0	25.0	4235.0	4.5	e
4 Cobas E / Elecsys	12	100.0	0.0	0.0	3370.1	4.3	e
5 Architect	4	100.0	0.0	0.0	4072.5	6.8	e*

TSH



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	13	100.0	0.0	0.0	3.75	2.8	e
2 Architect	13	100.0	0.0	0.0	2.80	7.3	e
3 VIDAS	15	93.3	6.7	0.0	3.76	7.8	e
4 AFIAS	35	100.0	0.0	0.0	3.66	8.2	e
5 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	3.19	5.9	e*

T3

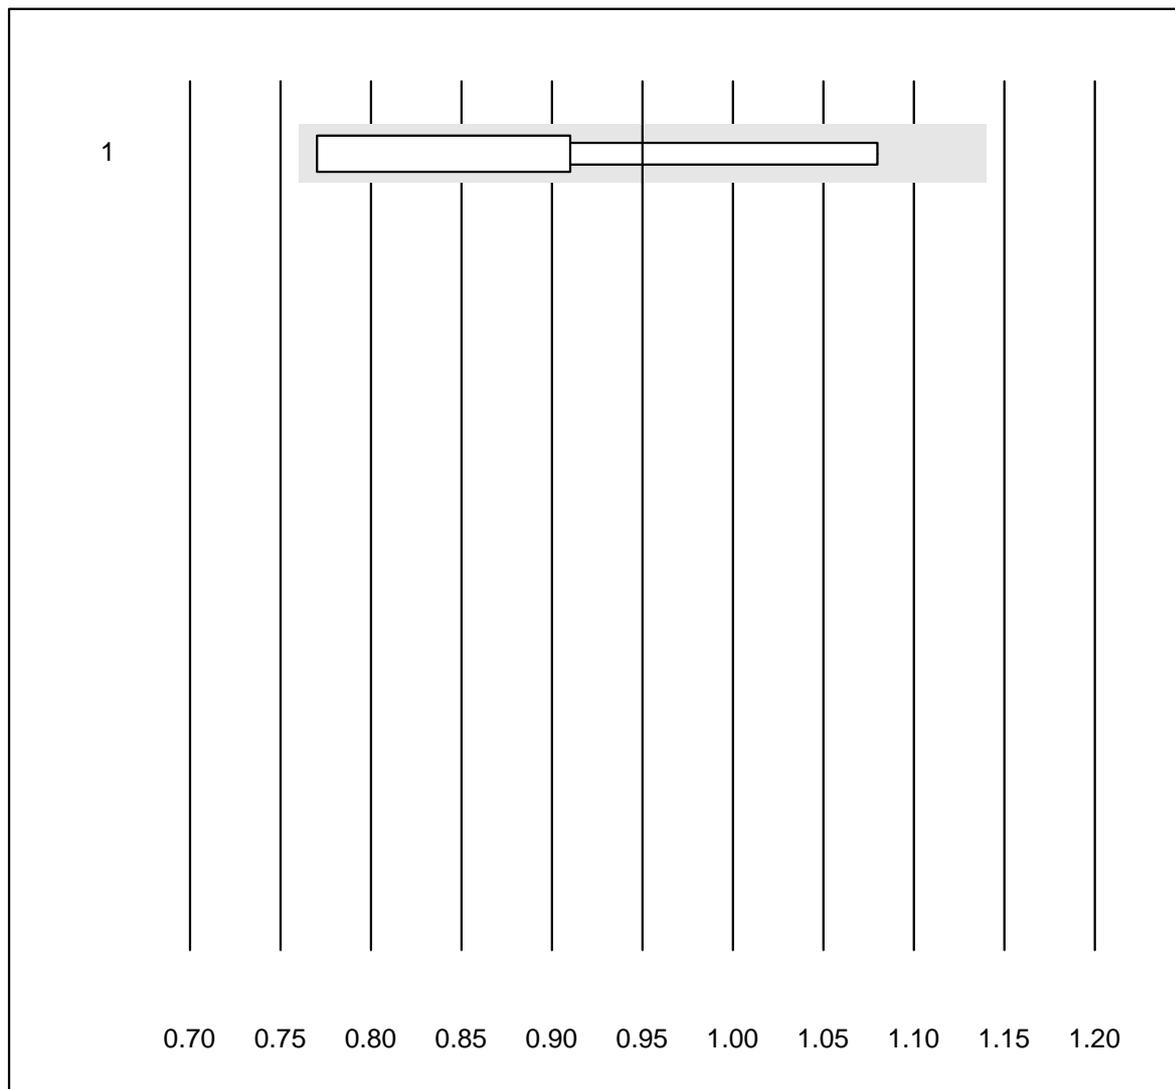


Tolérance MQ : 20 %

T3 (nmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 AFIAS	11	81.8	0.0	18.2	1.0	12.5	a

T4

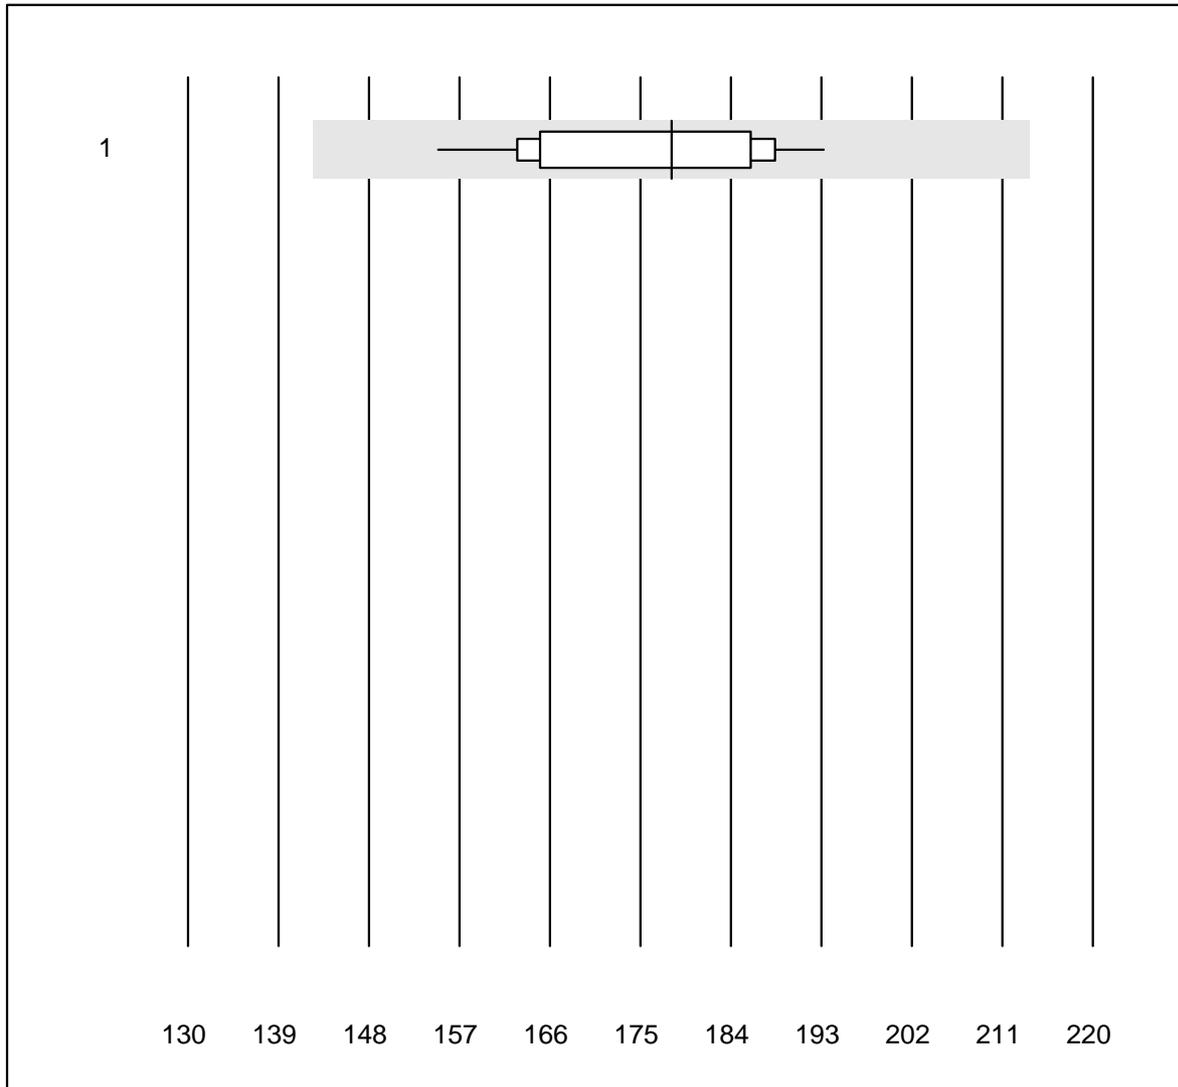


Tolérance MQ : 20 %

T4 (nmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 AFIAS	12	100.0	0.0	0.0	178	6.7	e

FT3

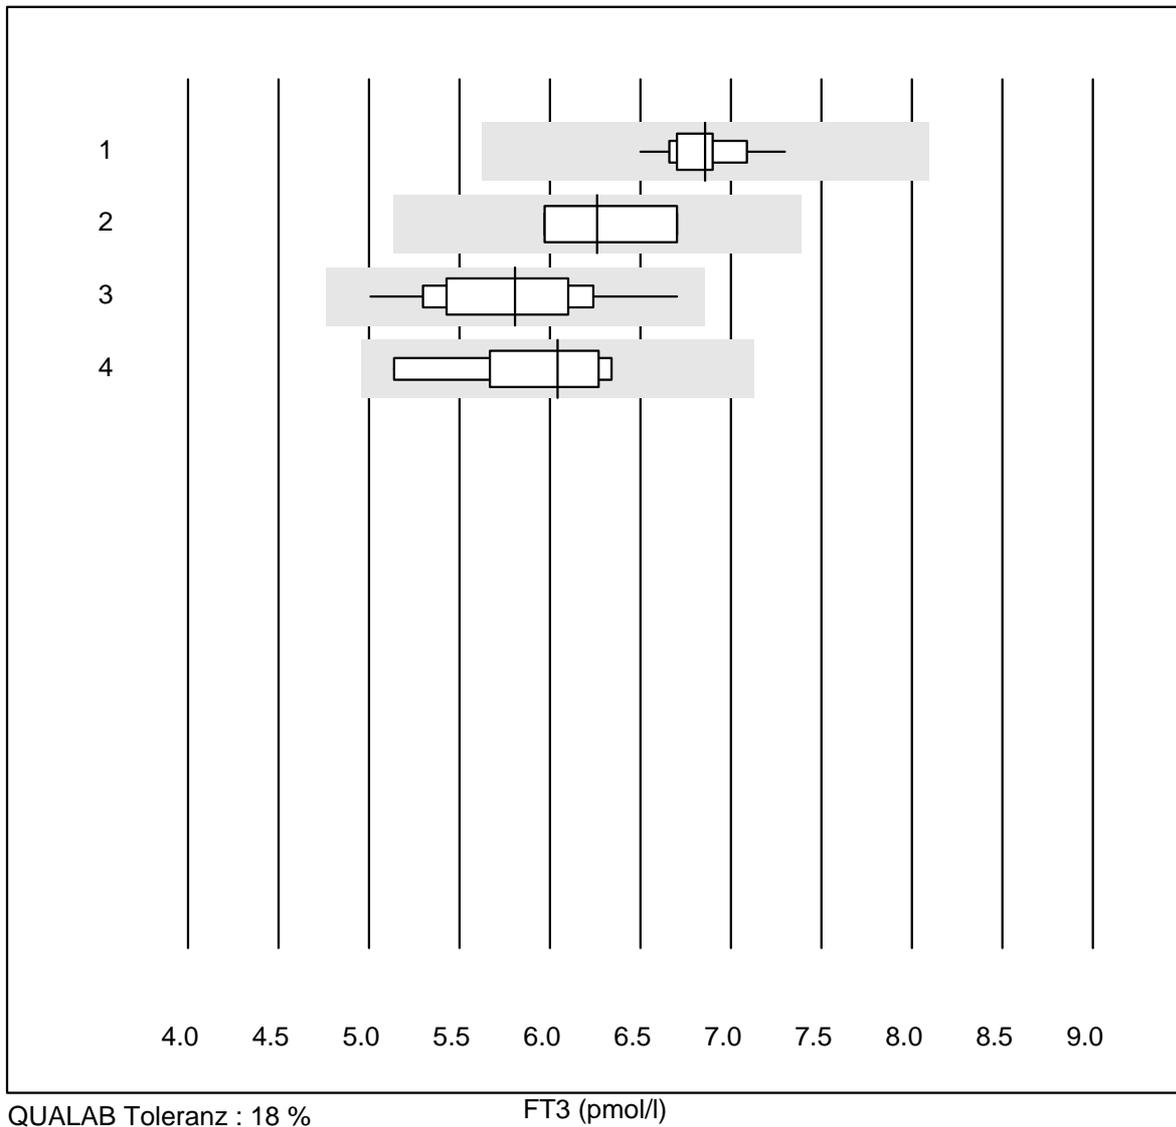


QUALAB Toleranz : 18 %

FT3 (pmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	12	100.0	0.0	0.0	6.9	3.1	e
2	ADVIA Centaur XP/CP	4	75.0	0.0	25.0	6.3	5.8	e*
3	Architect	11	100.0	0.0	0.0	5.8	8.2	e*
4	VIDAS	8	87.5	0.0	12.5	6.0	7.1	e*

FT4

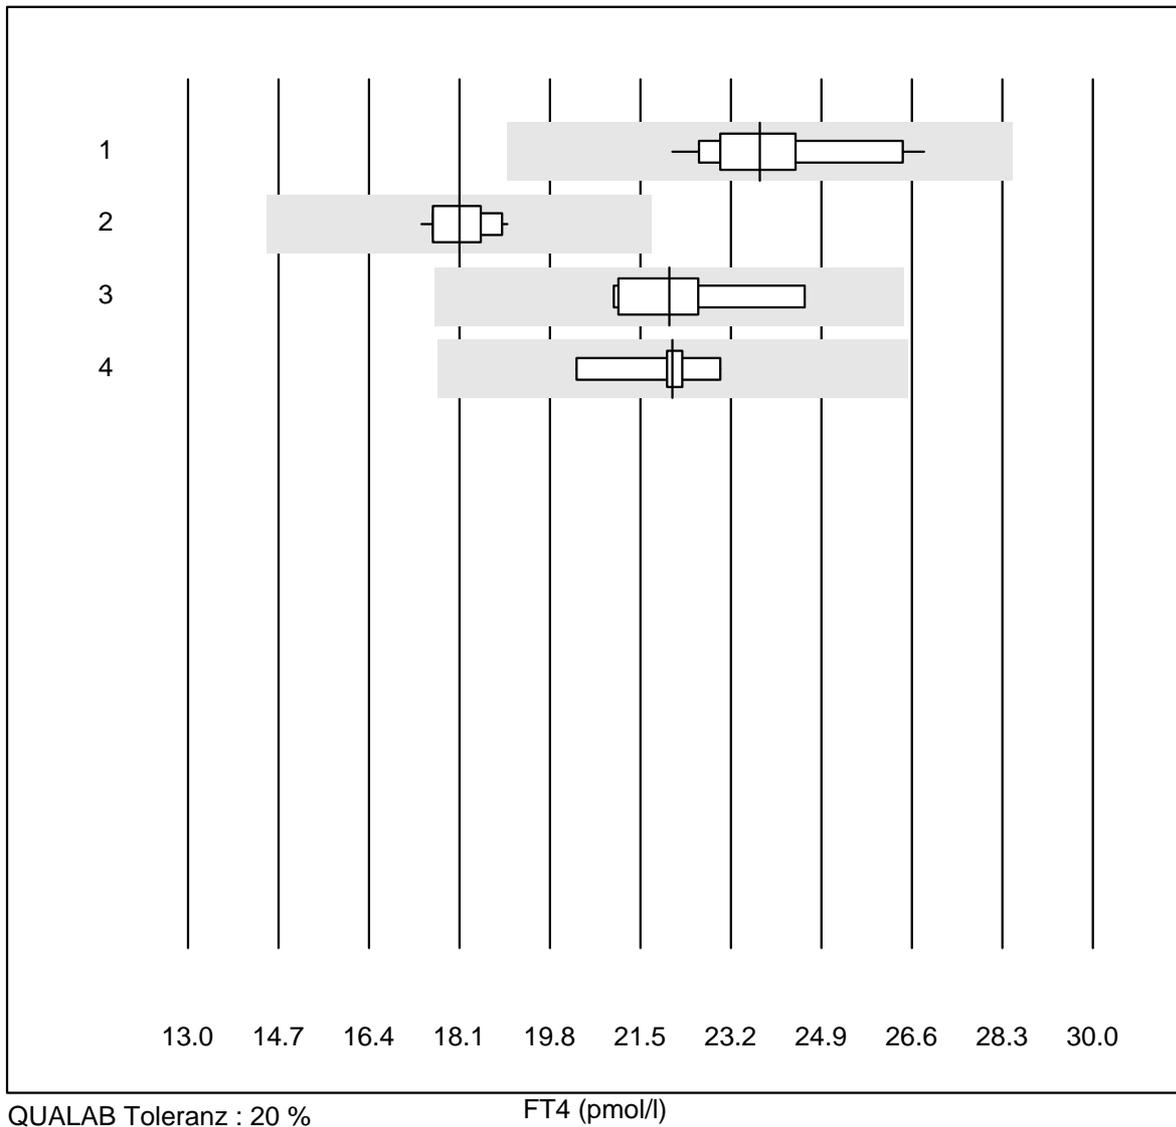

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	14	100.0	0.0	0.0	23.7	5.9	e
2 Architect	13	100.0	0.0	0.0	18.1	2.9	e
3 VIDAS	8	100.0	0.0	0.0	22.0	5.5	e
4 Autres méthodes	5	100.0	0.0	0.0	22.1	4.5	e

Testostérone

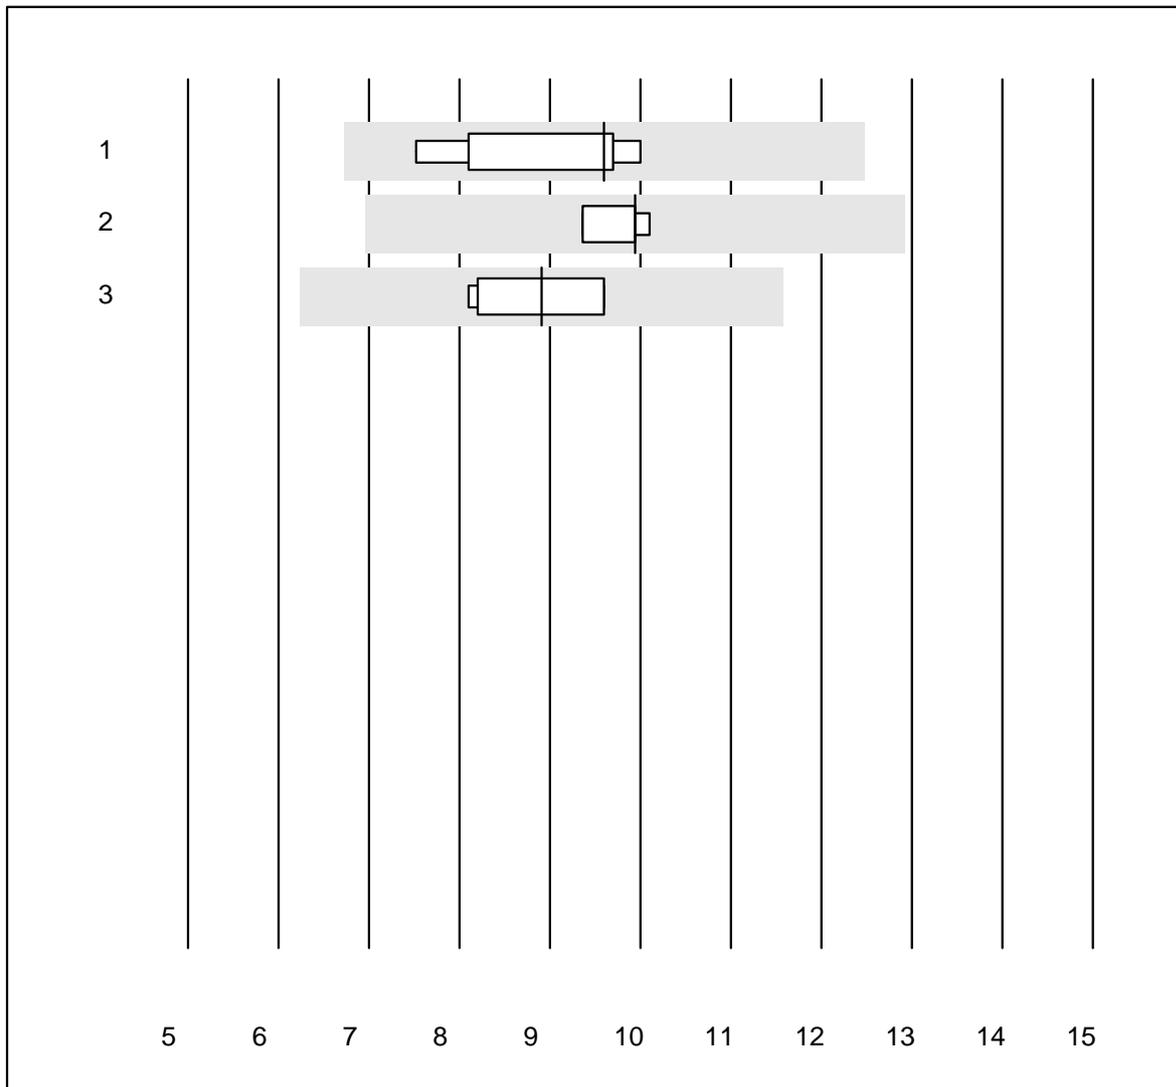


QUALAB Toleranz : 30 %

Testostérone (nmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	9.6	12.3	e*
2 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	9.9	3.7	e
3 Architect	6	100.0	0.0	0.0	8.9	7.6	e

Estradiol

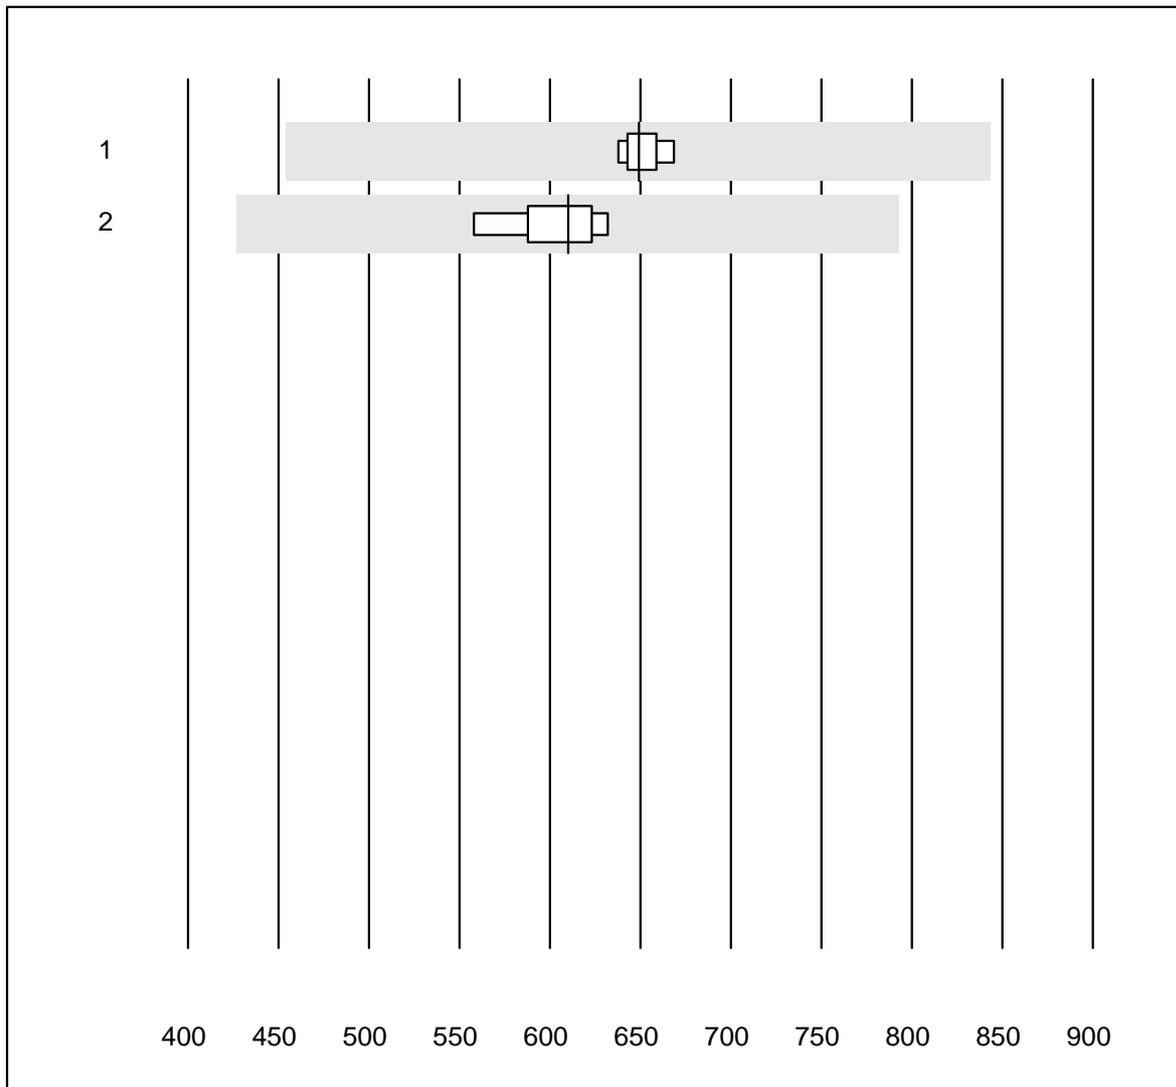


Tolérance MQ : 30 %

Estradiol (pmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	6	100.0	0.0	0.0	649	1.8	e
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	610	4.9	e

SHBG

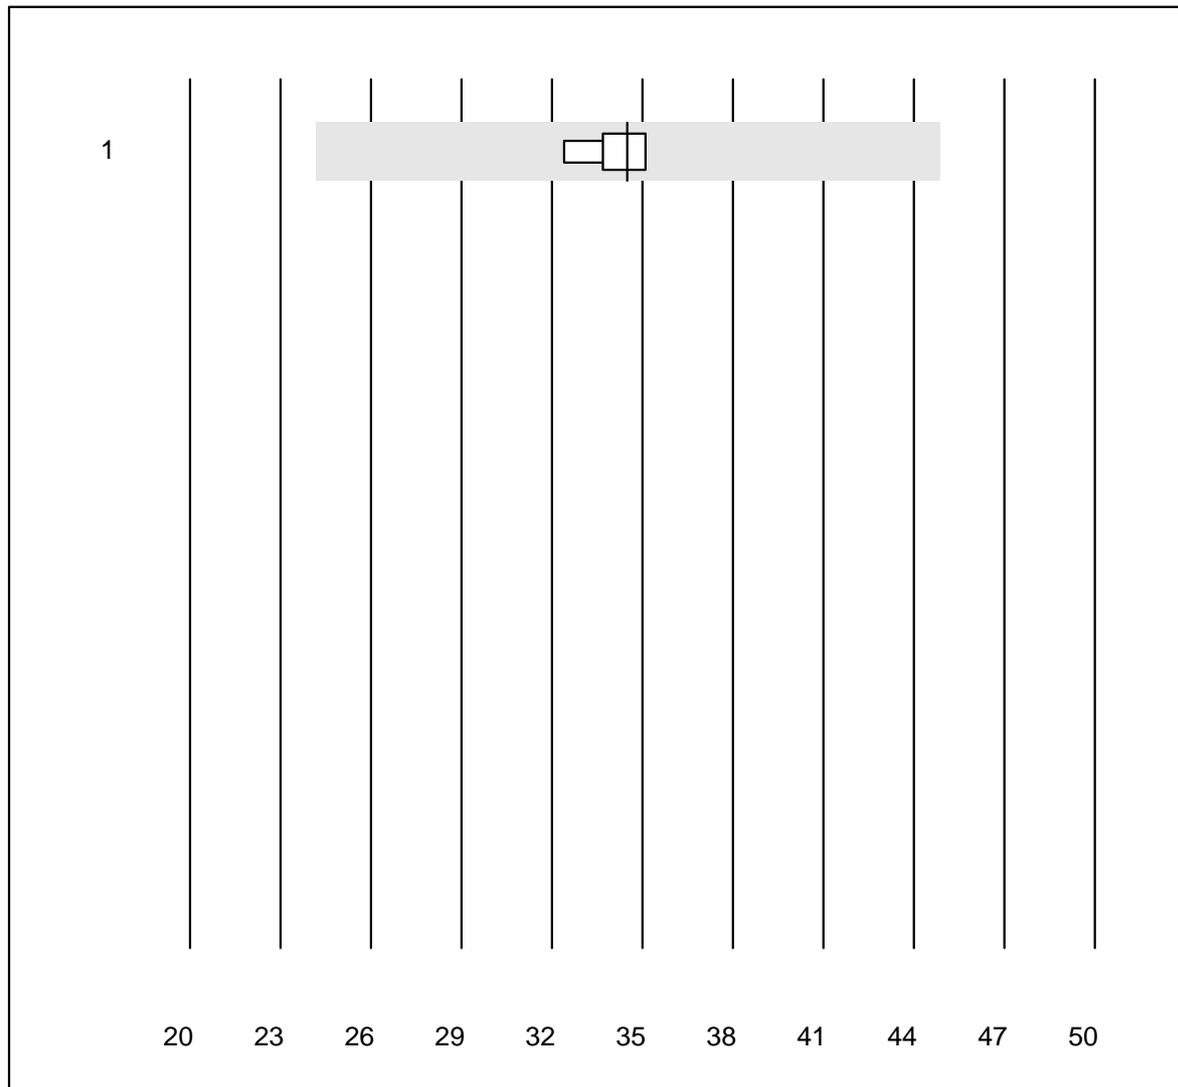


Tolérance MQ : 30 %

SHBG (nmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	34.5	3.3	e

Cortisol

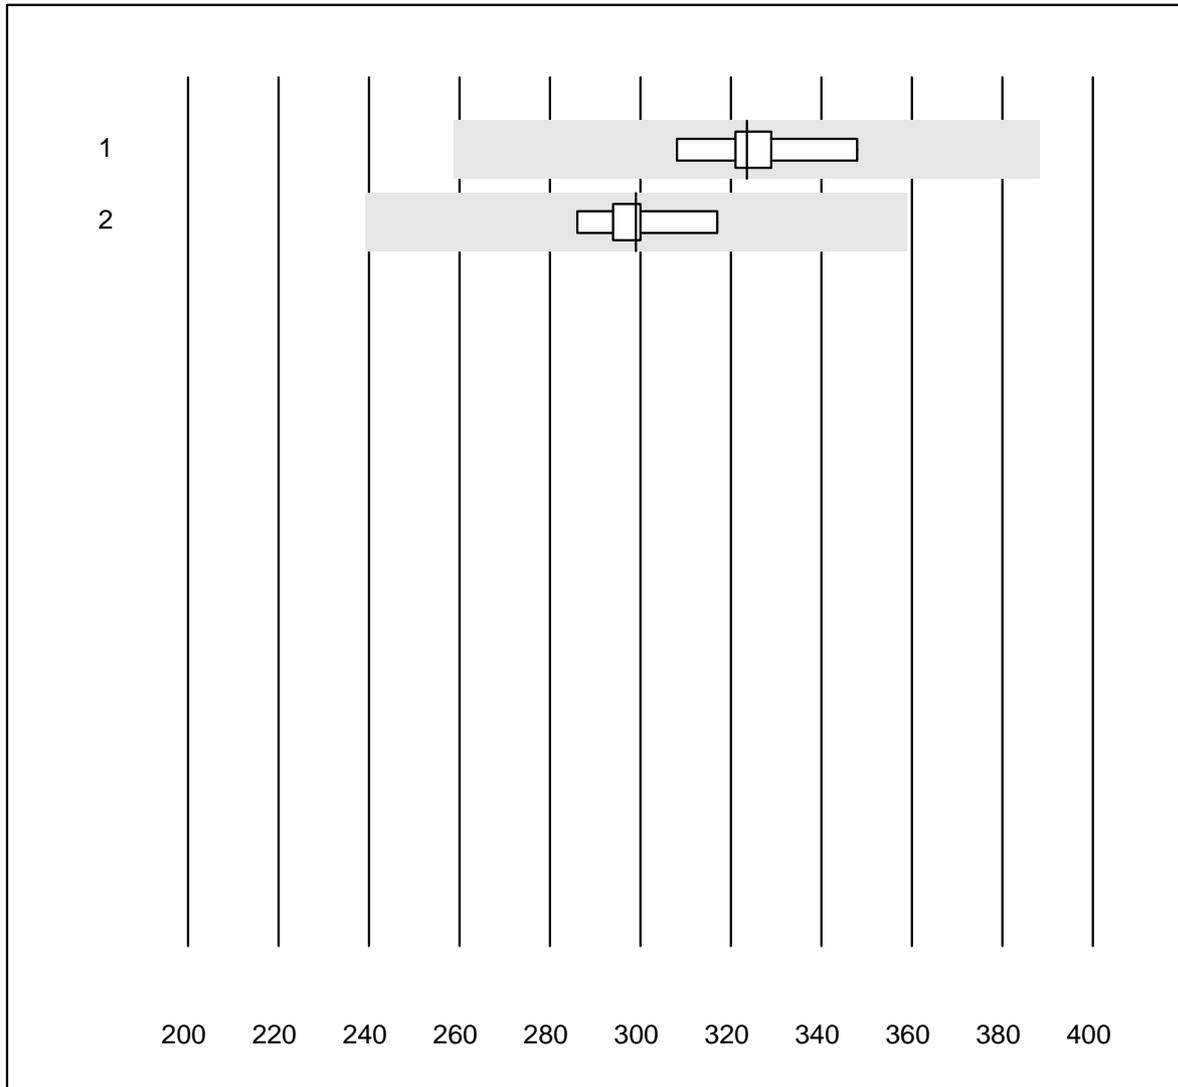


QUALAB Toleranz : 20 %

Cortisol (nmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	7	100.0	0.0	0.0	324	3.7	e
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	299	3.8	e

Progesteron

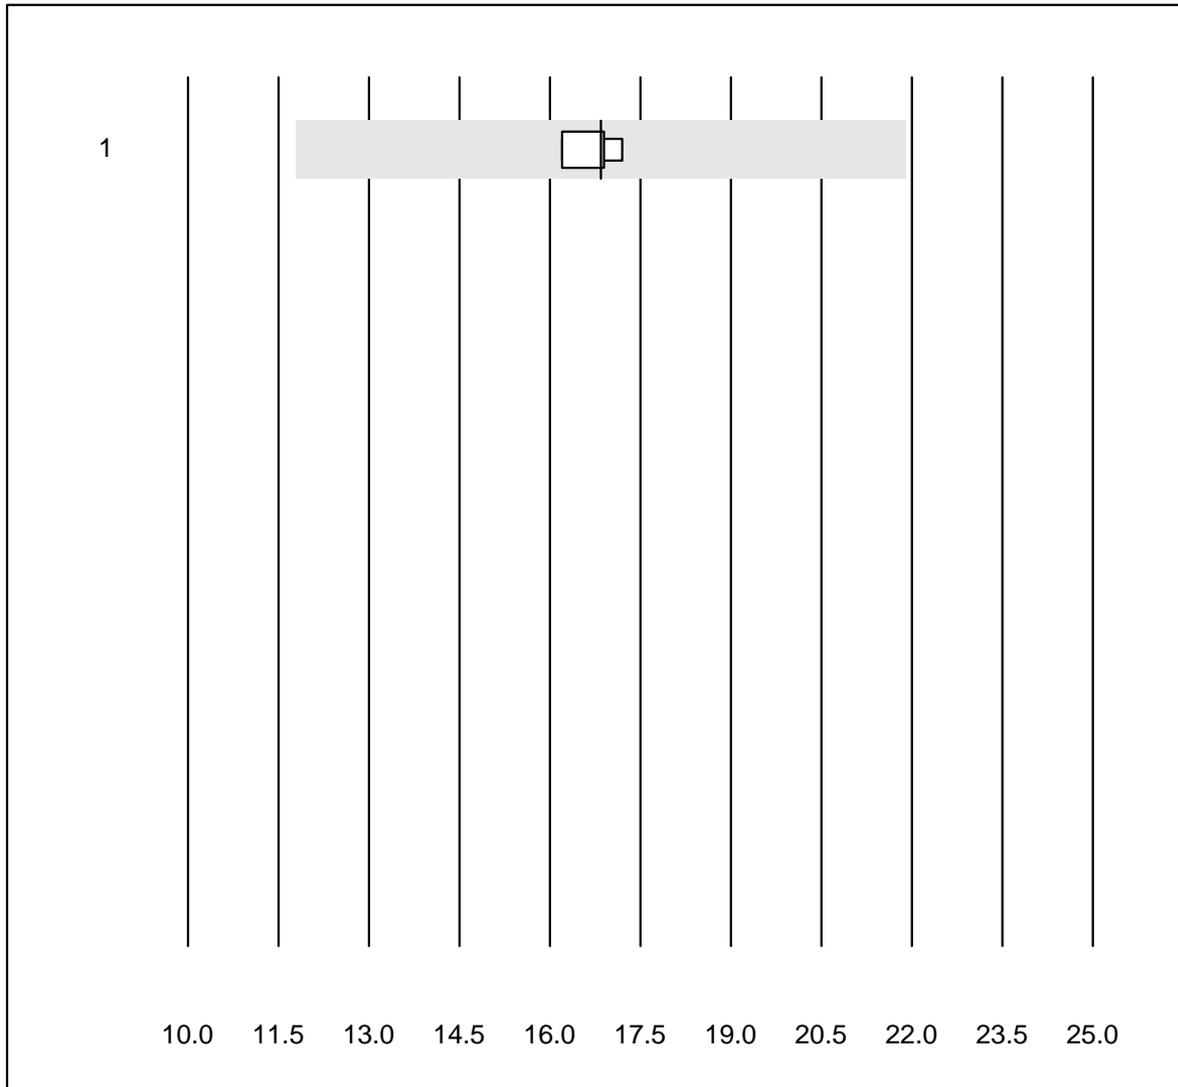


Tolérance MQ : 30 %

Progesteron (nmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Architect	4	100.0	0.0	0.0	16.9	2.5	e

DHEAS

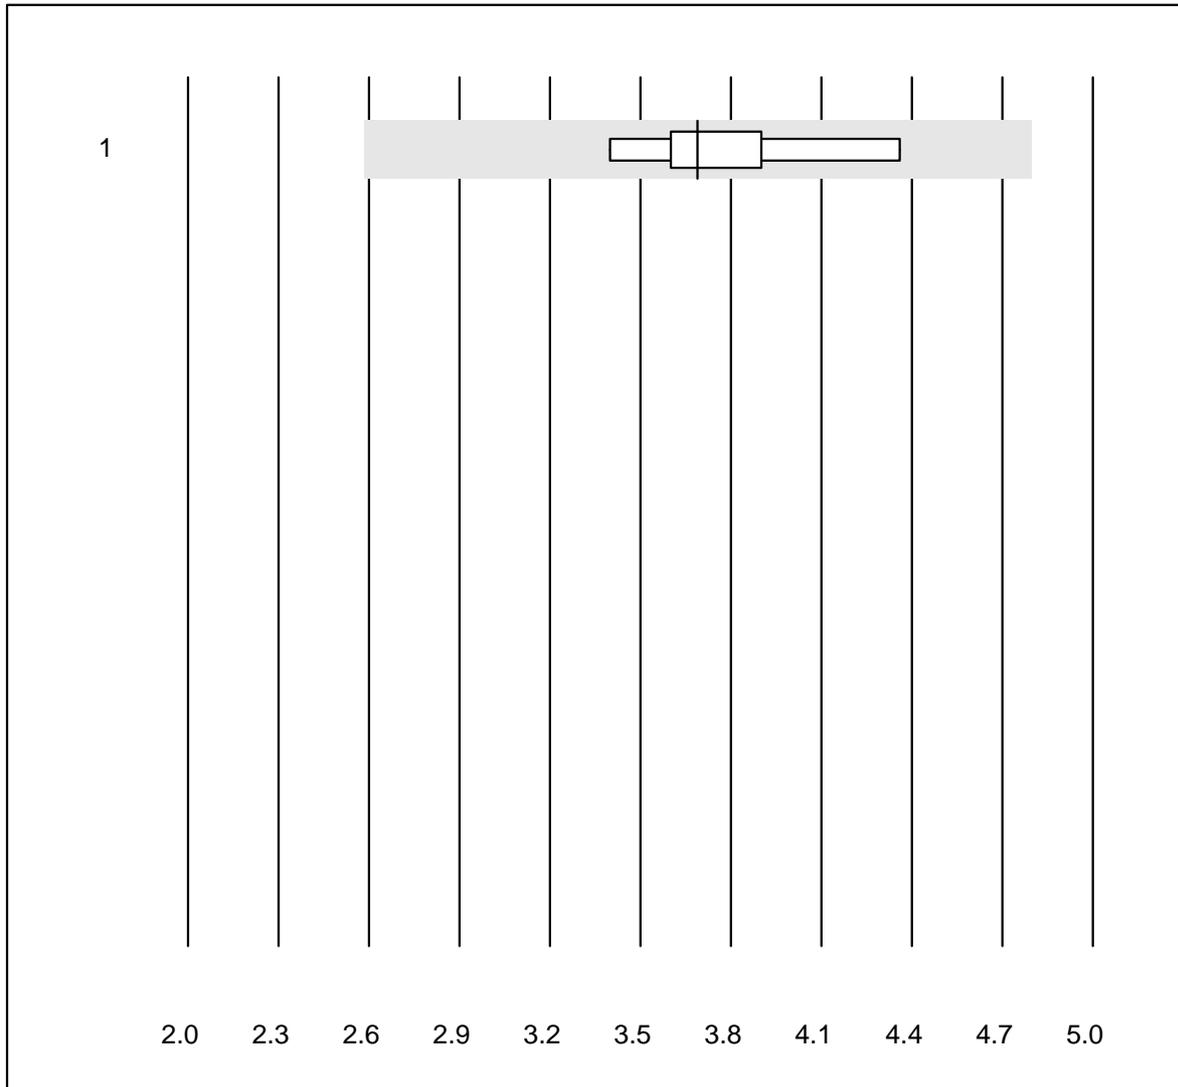


Tolérance MQ : 30 %

DHEAS (µmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	3.69	9.5	e*

Luteinisierendes Hormon

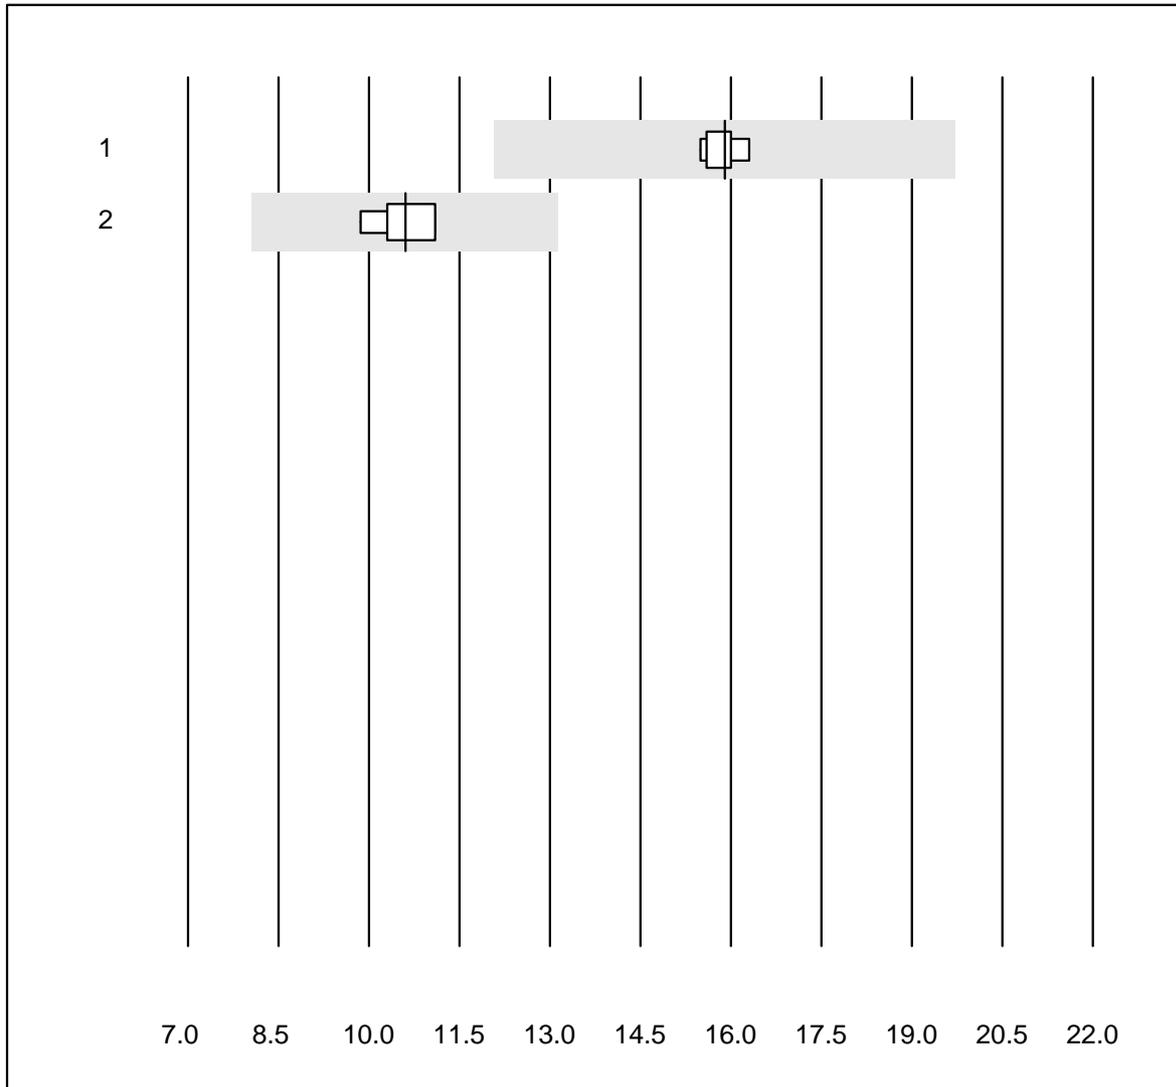


QUALAB Toleranz : 24 %

Luteinisierendes Hormon (U/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Roche, Cobas	7	100.0	0.0	0.0	15.9	1.7	e
2	Architect	5	100.0	0.0	0.0	10.6	5.0	e

Follikelstimulierendes Hormon

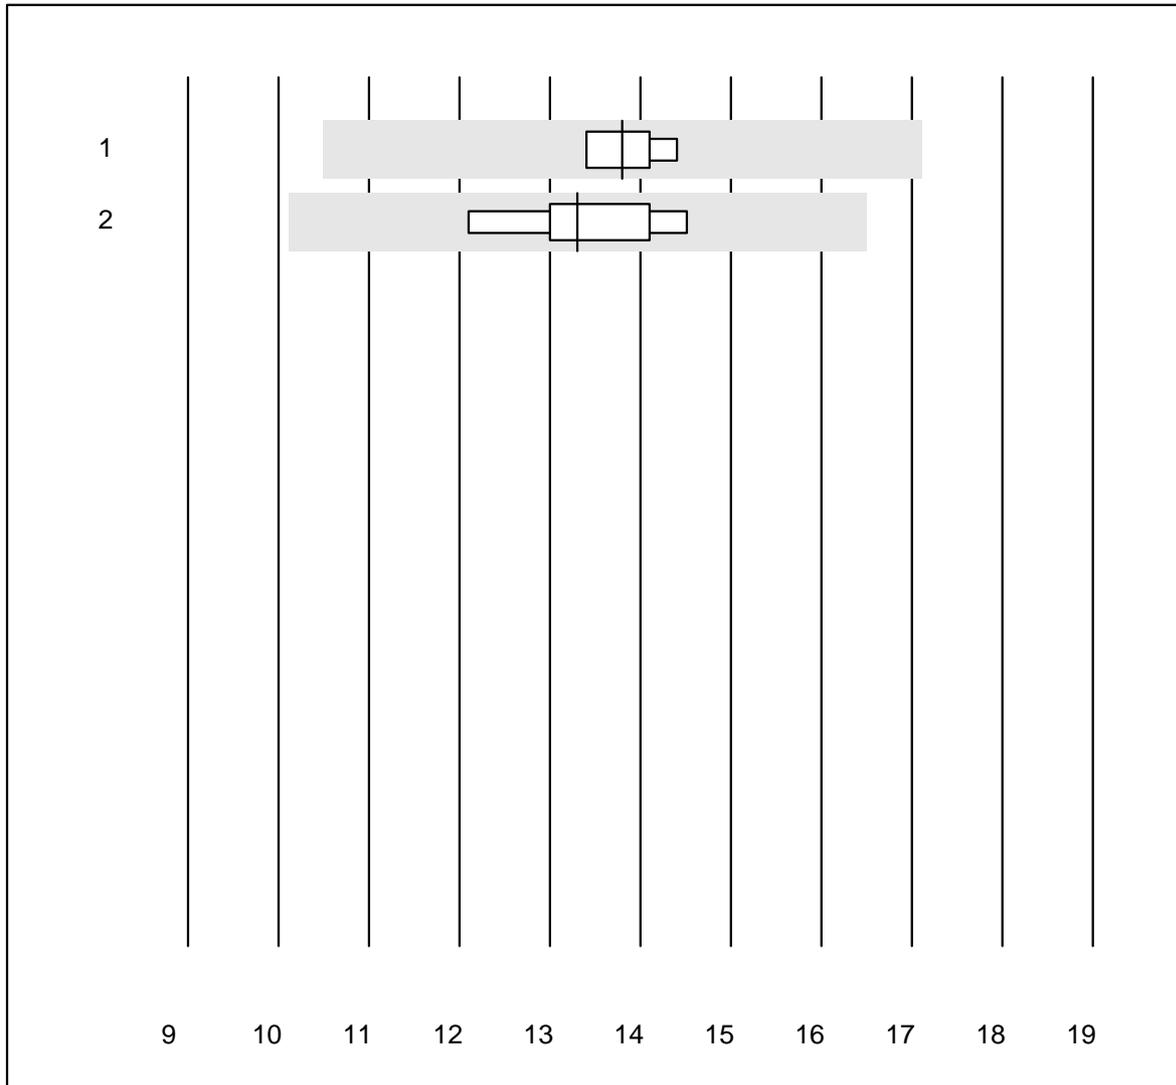


QUALAB Toleranz : 24 %

Follikelstimulierendes Hormon (U/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Roche, Cobas	7	100.0	0.0	0.0	13.8	3.0	e
2	Architect	5	100.0	0.0	0.0	13.3	7.1	e*

Prolaktin (PRL)

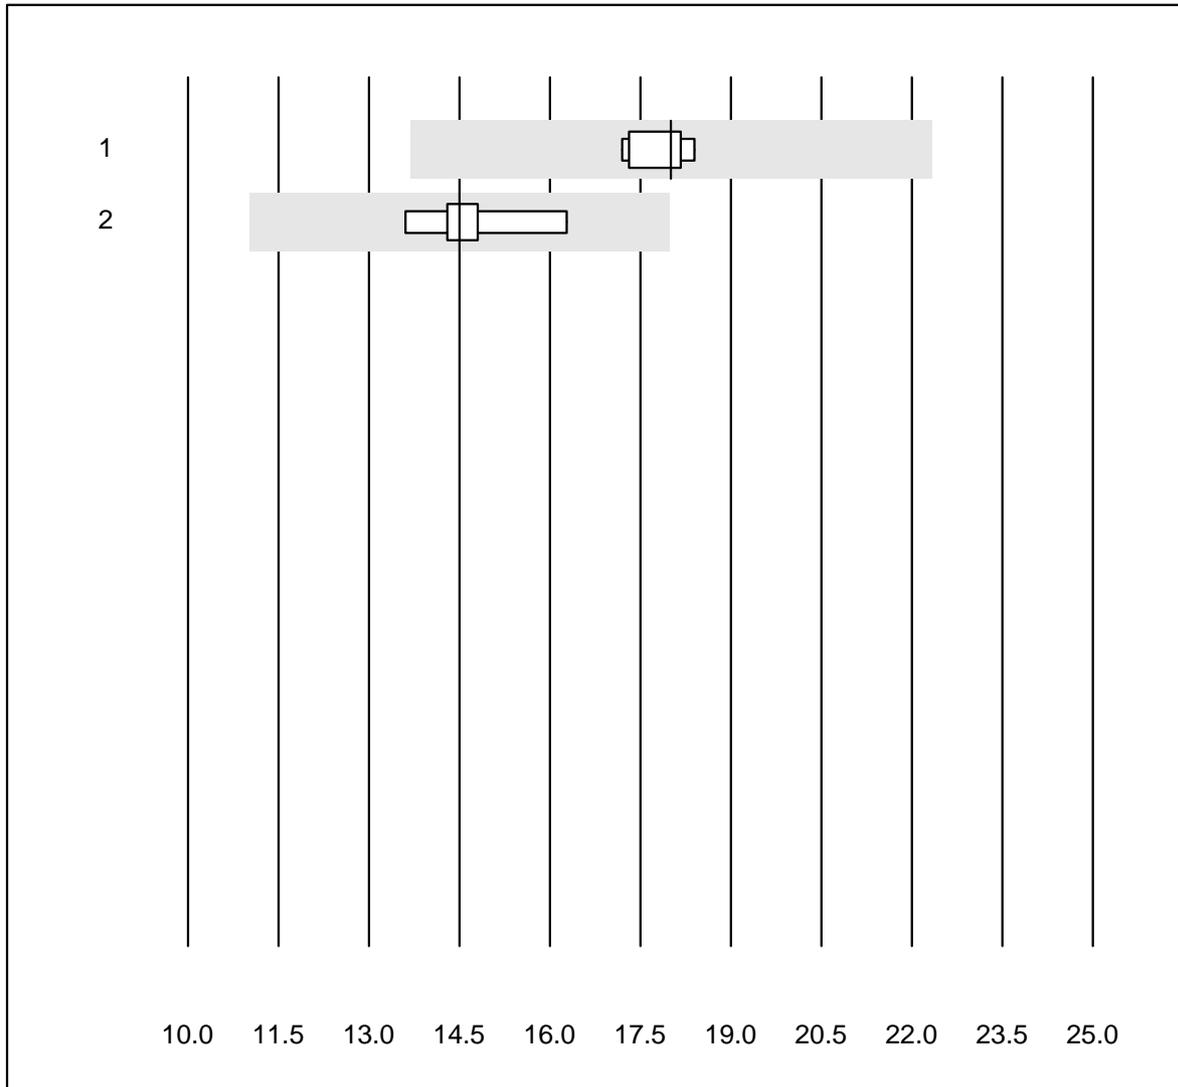


QUALAB Toleranz : 24 %

Prolaktin (PRL) (µg/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas/Roche	7	100.0	0.0	0.0	18.0	2.7	e
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	14.5	6.7	e*

HGH

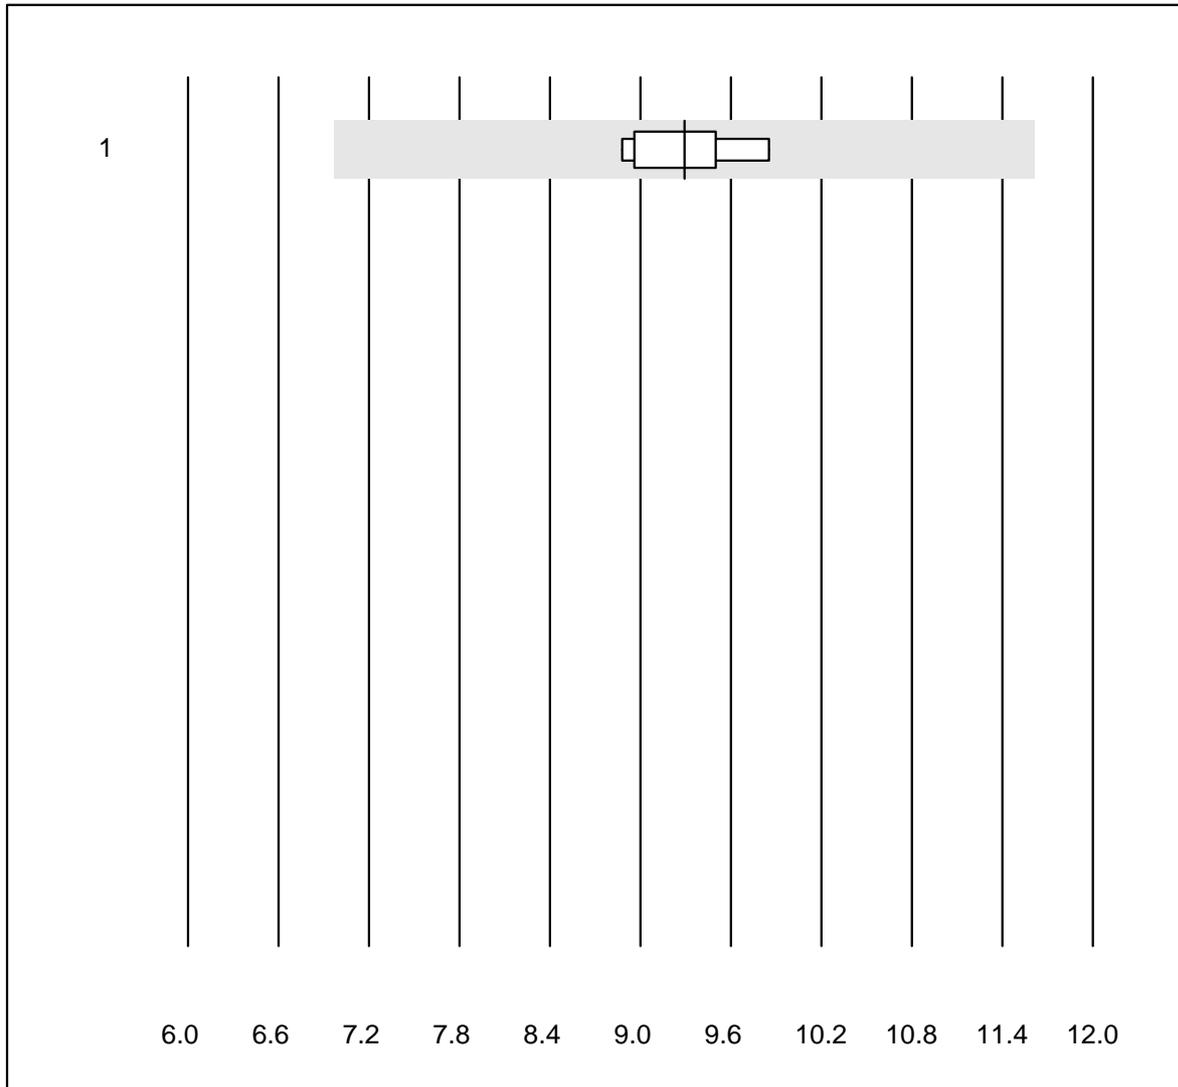


Tolérance MQ : 25 %

HGH (µg/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	9.29	3.9	e

IGF-1

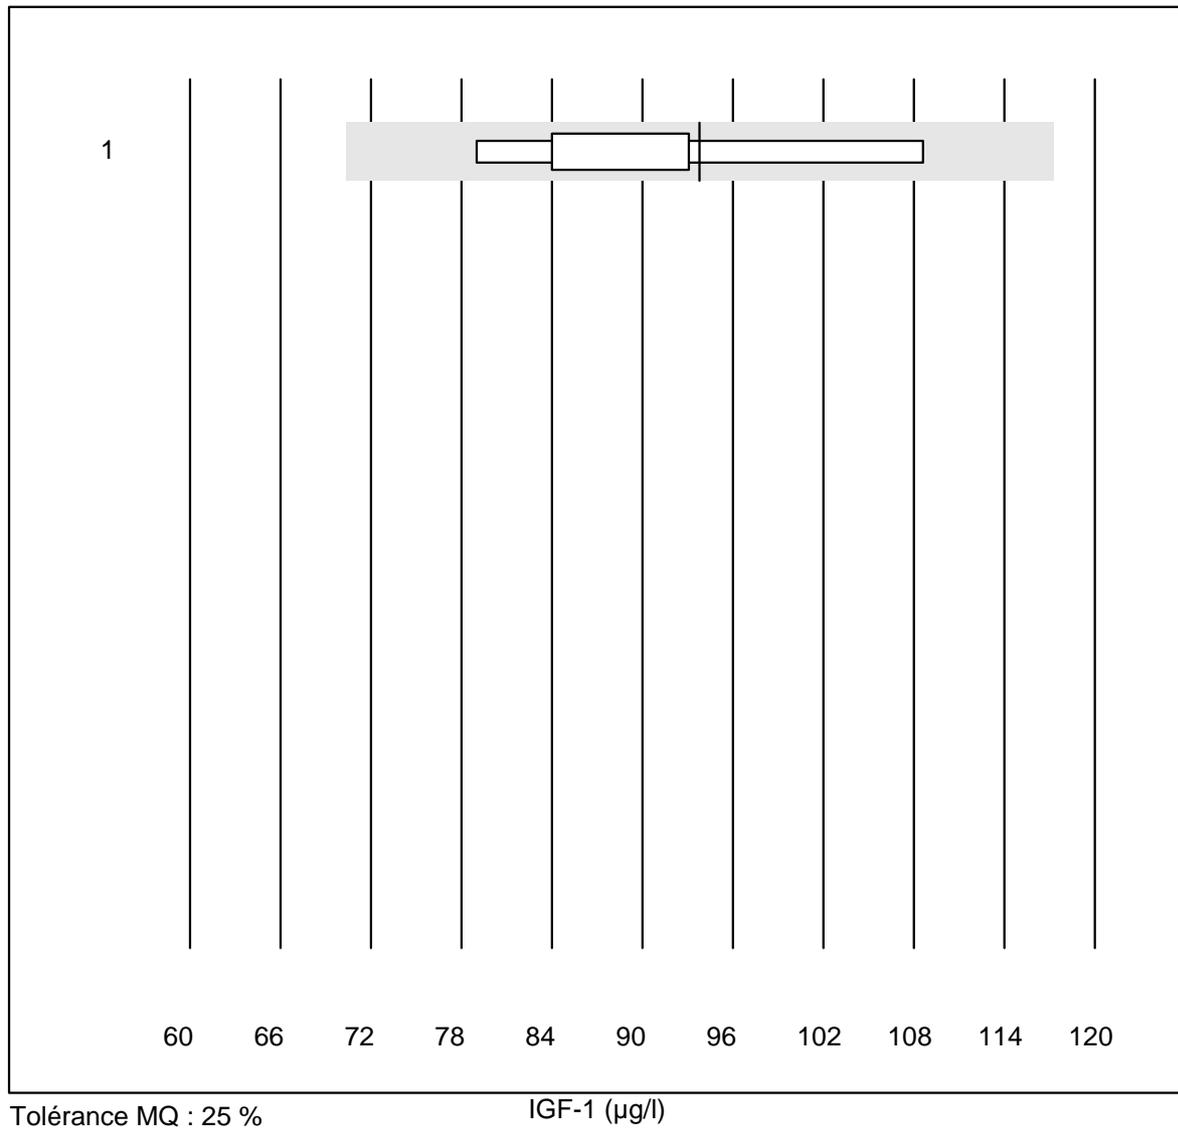

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Liaison	6	100.0	0.0	0.0	94	11.3	a

Troponine T CR

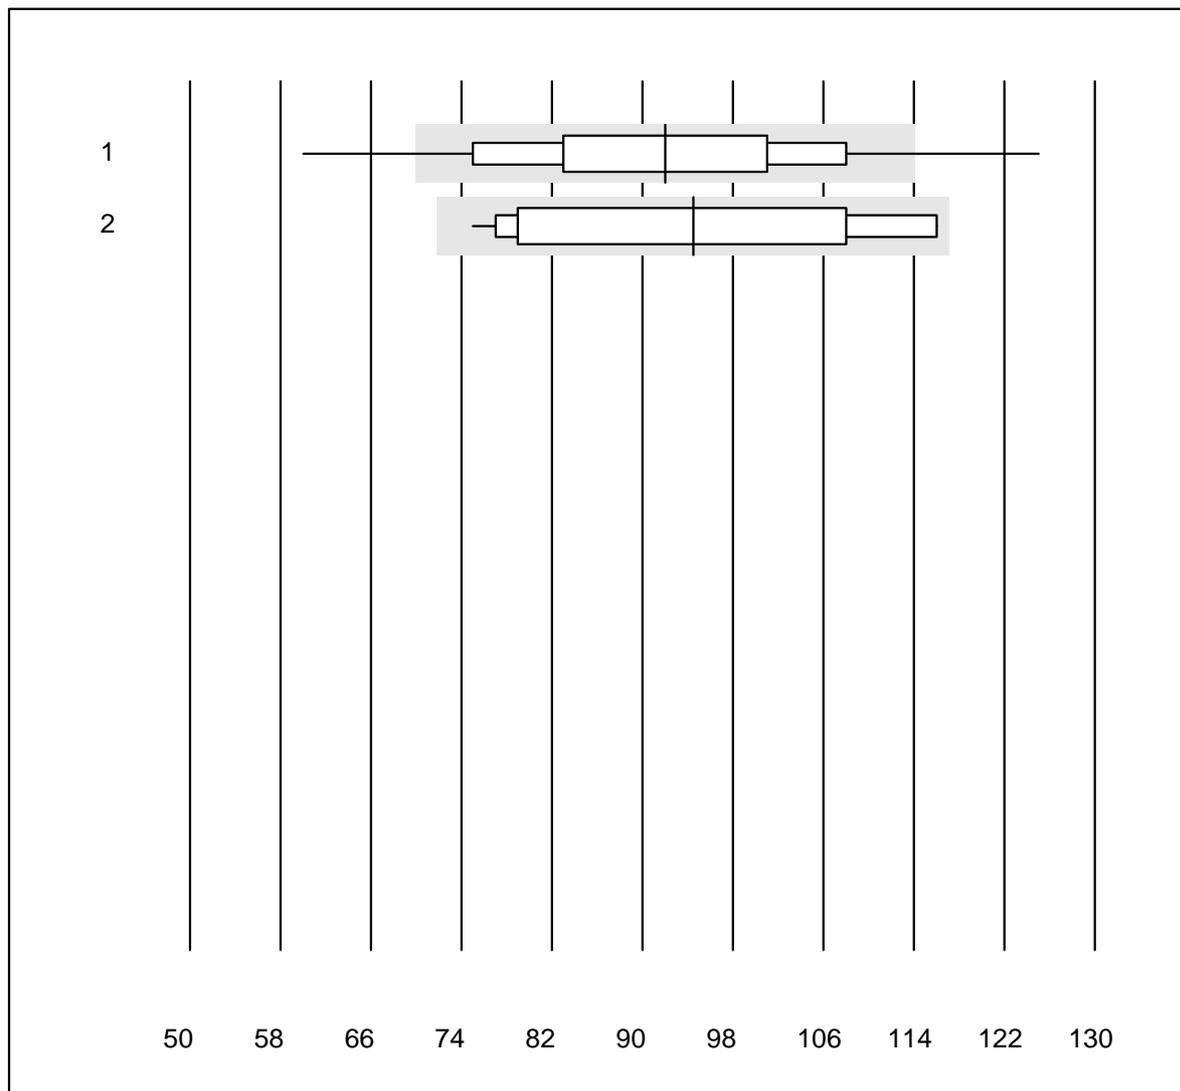


QUALAB Toleranz : 24 %

Troponine T CR (ng/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas h 232	1210	91.5	7.5	1.0	92.00	13.7	e
2 Cardiac Reader	14	100.0	0.0	0.0	94.50	16.0	e*

Troponin I WB

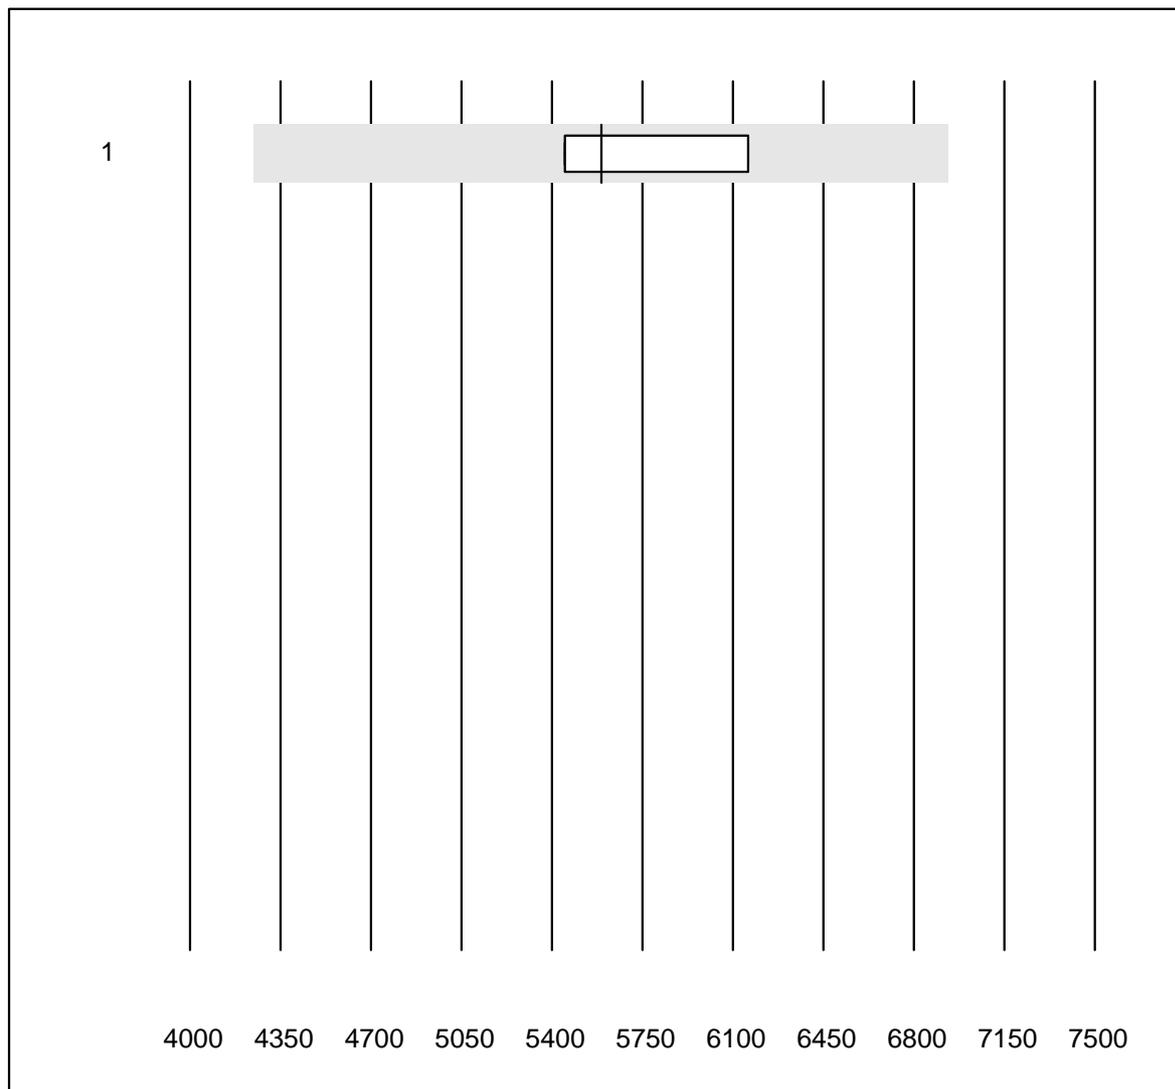


QUALAB Toleranz : 24 %

Troponin I WB (ng/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 iStat	4	75.0	0.0	25.0	5590.00	6.2	e*

D-Dimères CR

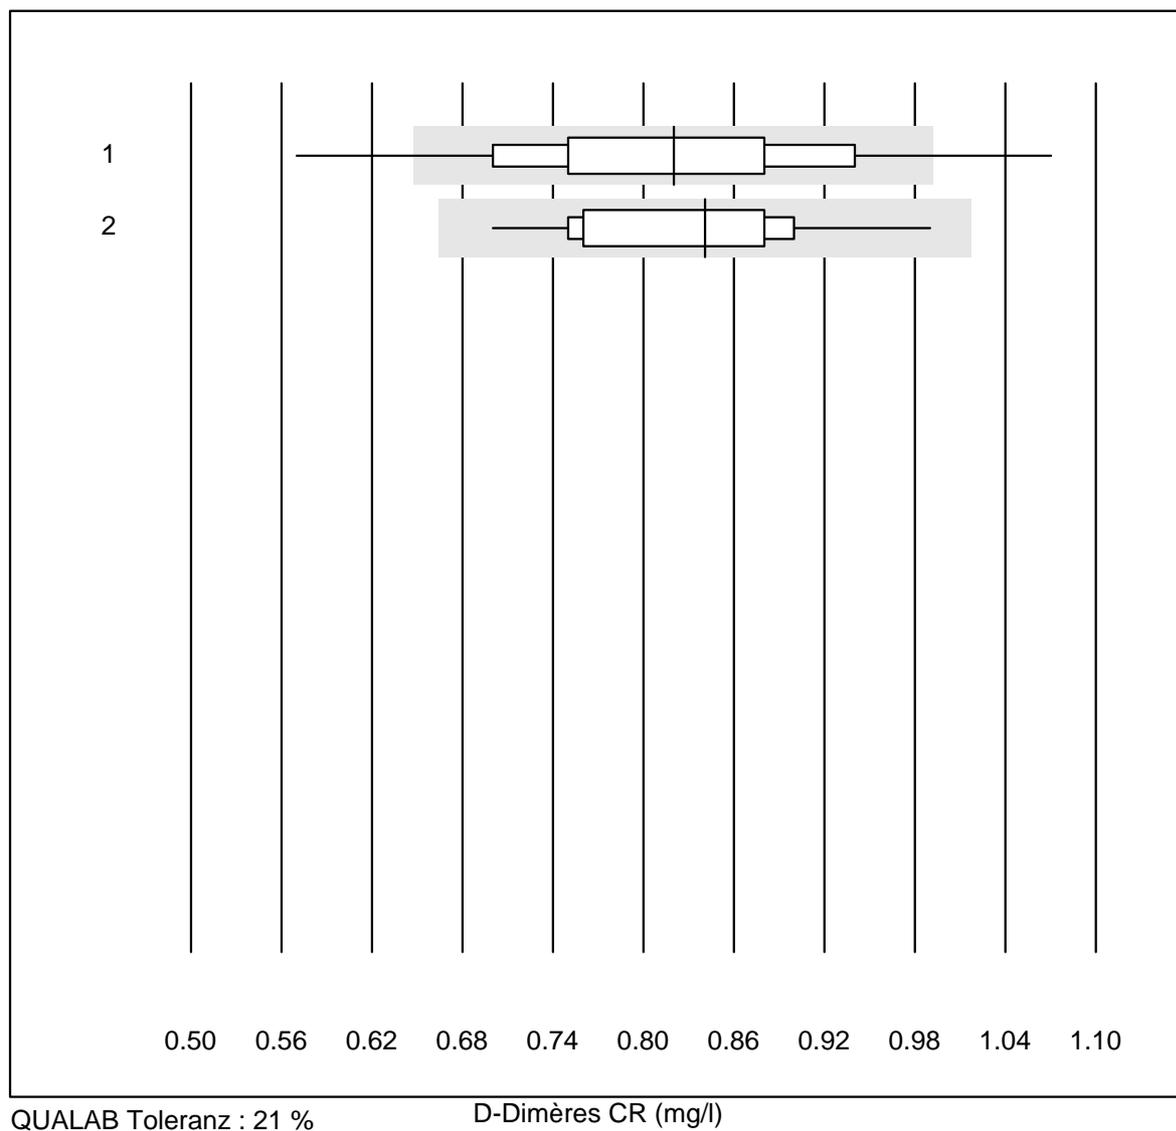


QUALAB Toleranz : 21 %

D-Dimères CR (mg/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas h 232	1190	93.2	5.0	1.8	0.82	11.1	e
2 Cardiac Reader	12	100.0	0.0	0.0	0.84	9.4	e*

CKMB- K8

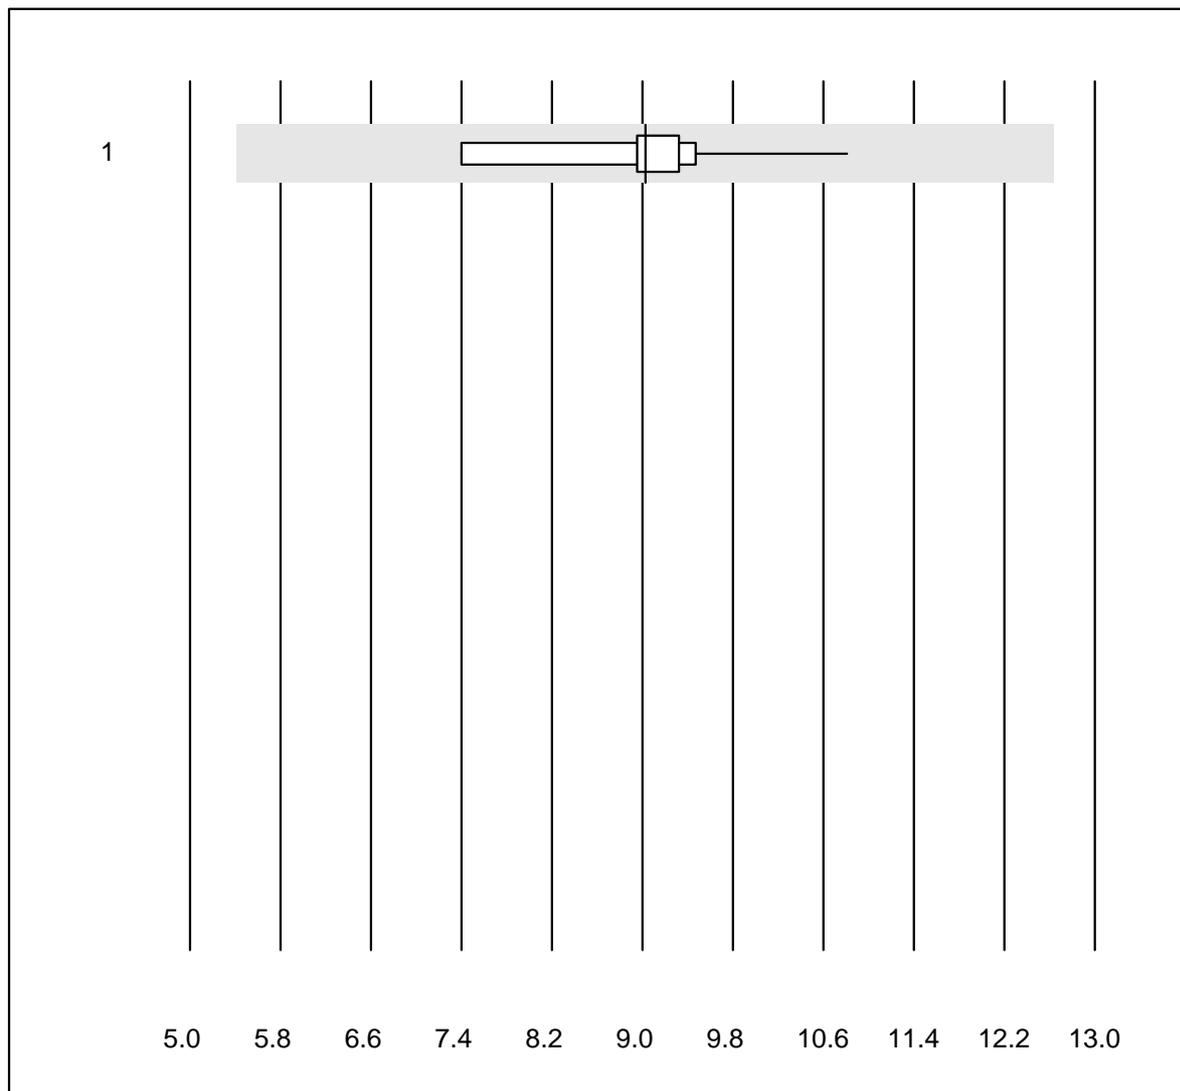


Tolérance MQ : 40 %

CKMB- K8 (µg/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas h 232	10	100.0	0.0	0.0	9.0	9.8	e

NT-proBNP CR

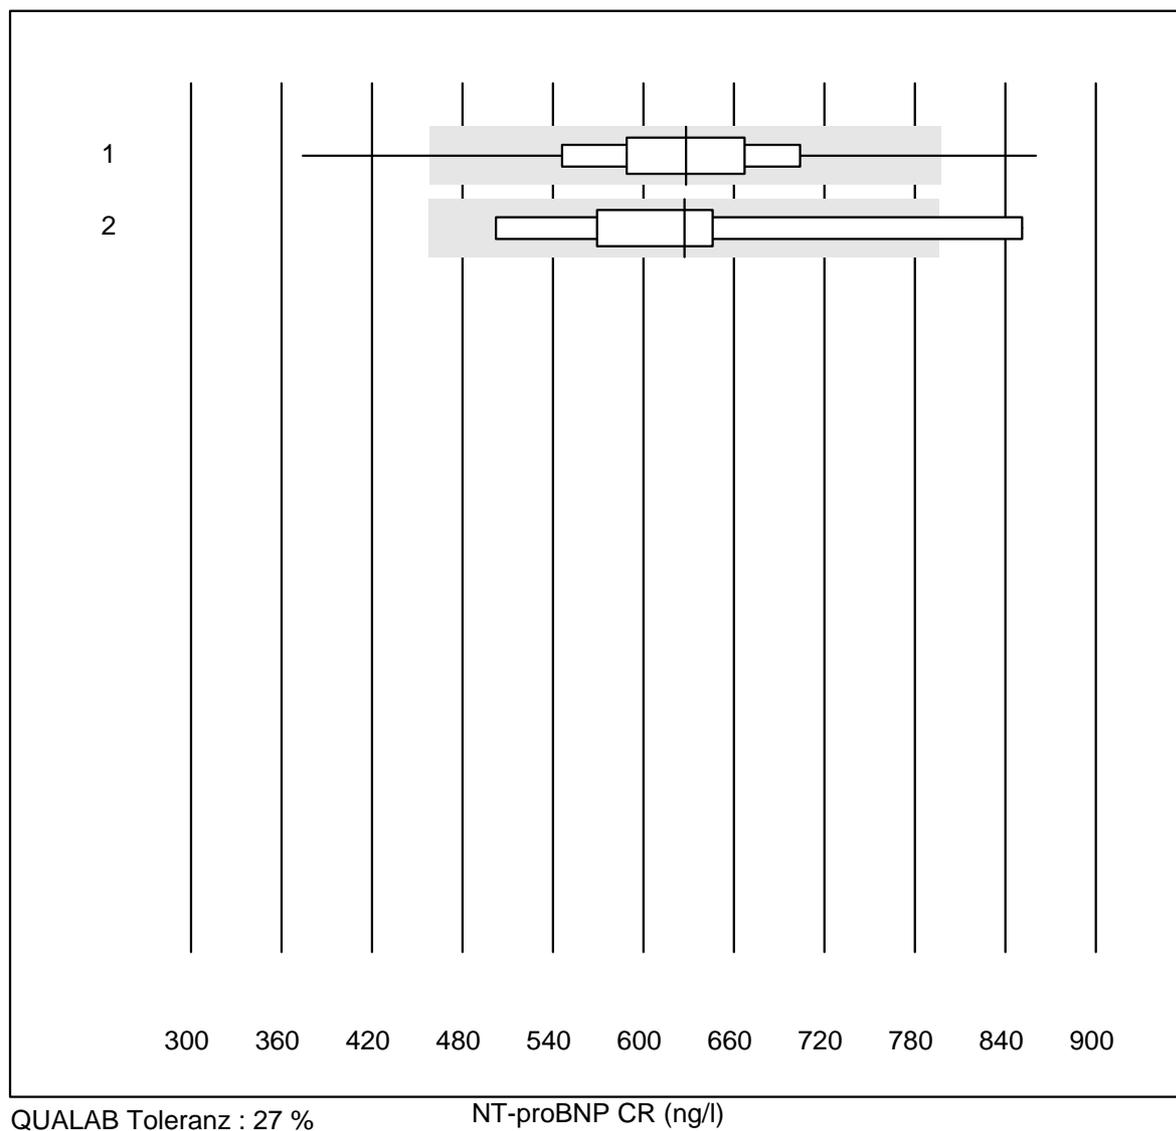


QUALAB Toleranz : 27 %

NT-proBNP CR (ng/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas h 232	755	98.4	1.1	0.5	628	10.1	e
2	Cardiac Reader	5	80.0	20.0	0.0	627	20.5	e*

PCO2 CCA

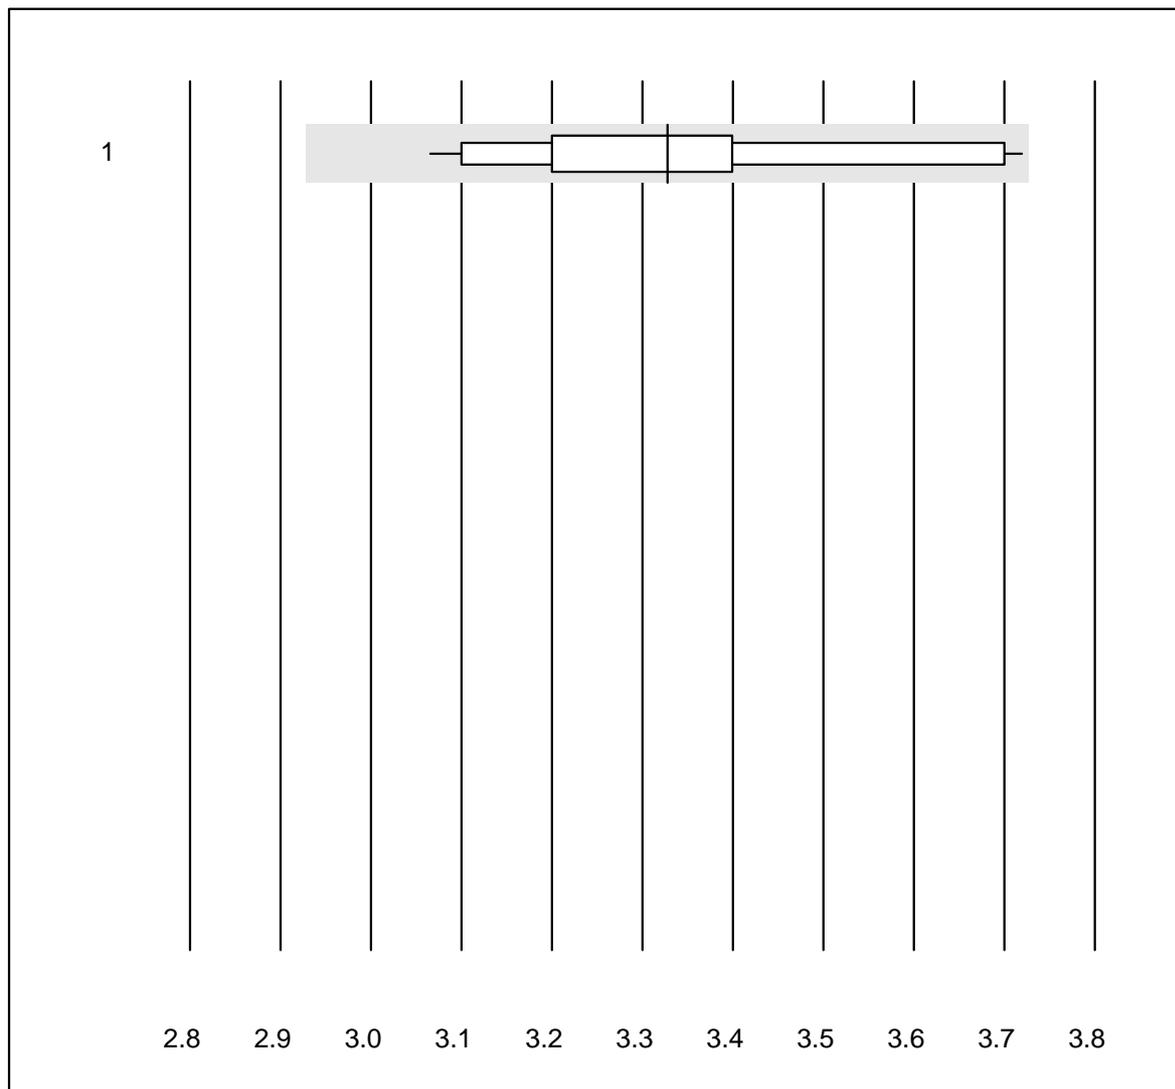


QUALAB Toleranz : 12 %

PCO2 CCA (kPa)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 OPTI CCA	13	100.0	0.0	0.0	3.33	6.1	e*

PO2 CCA

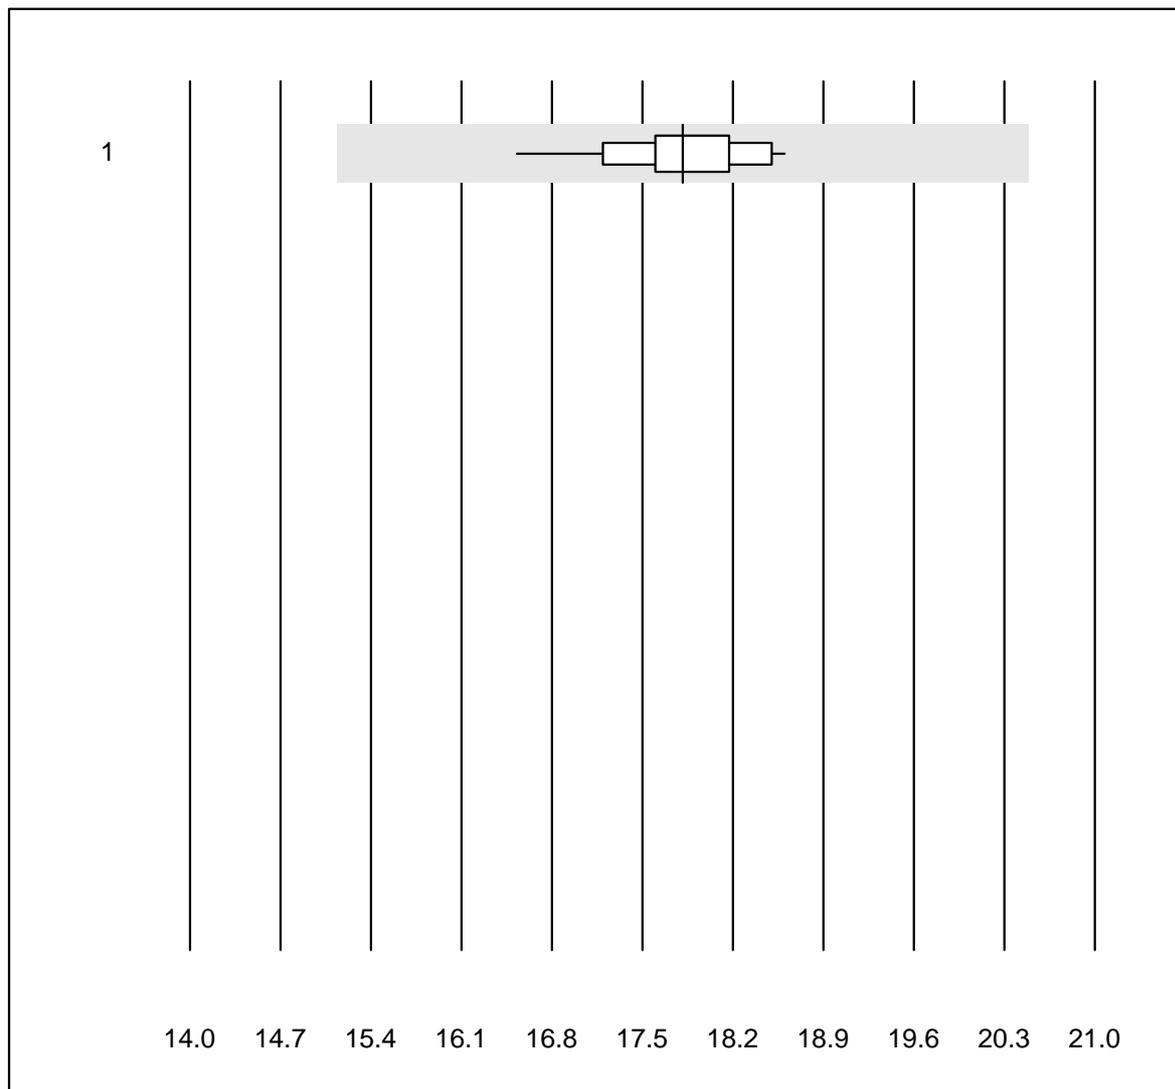


QUALAB Toleranz : 15 %

PO2 CCA (kPa)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 OPTI CCA	13	100.0	0.0	0.0	17.81	3.2	e

pH CCA

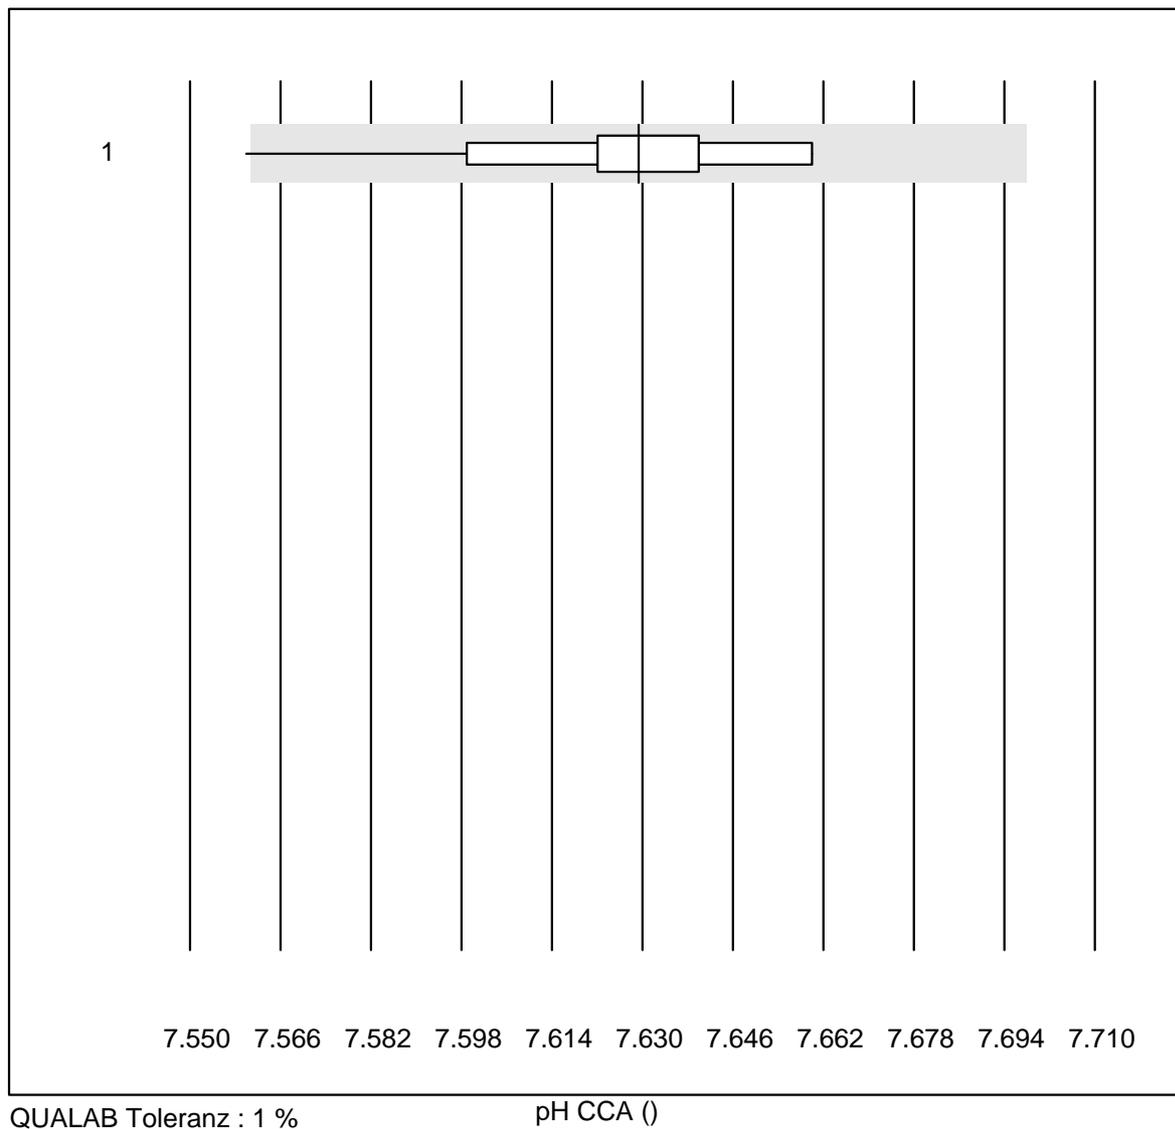

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 OPTI CCA	12	91.7	8.3	0.0	7.63	0.4	e

Potassium CCA

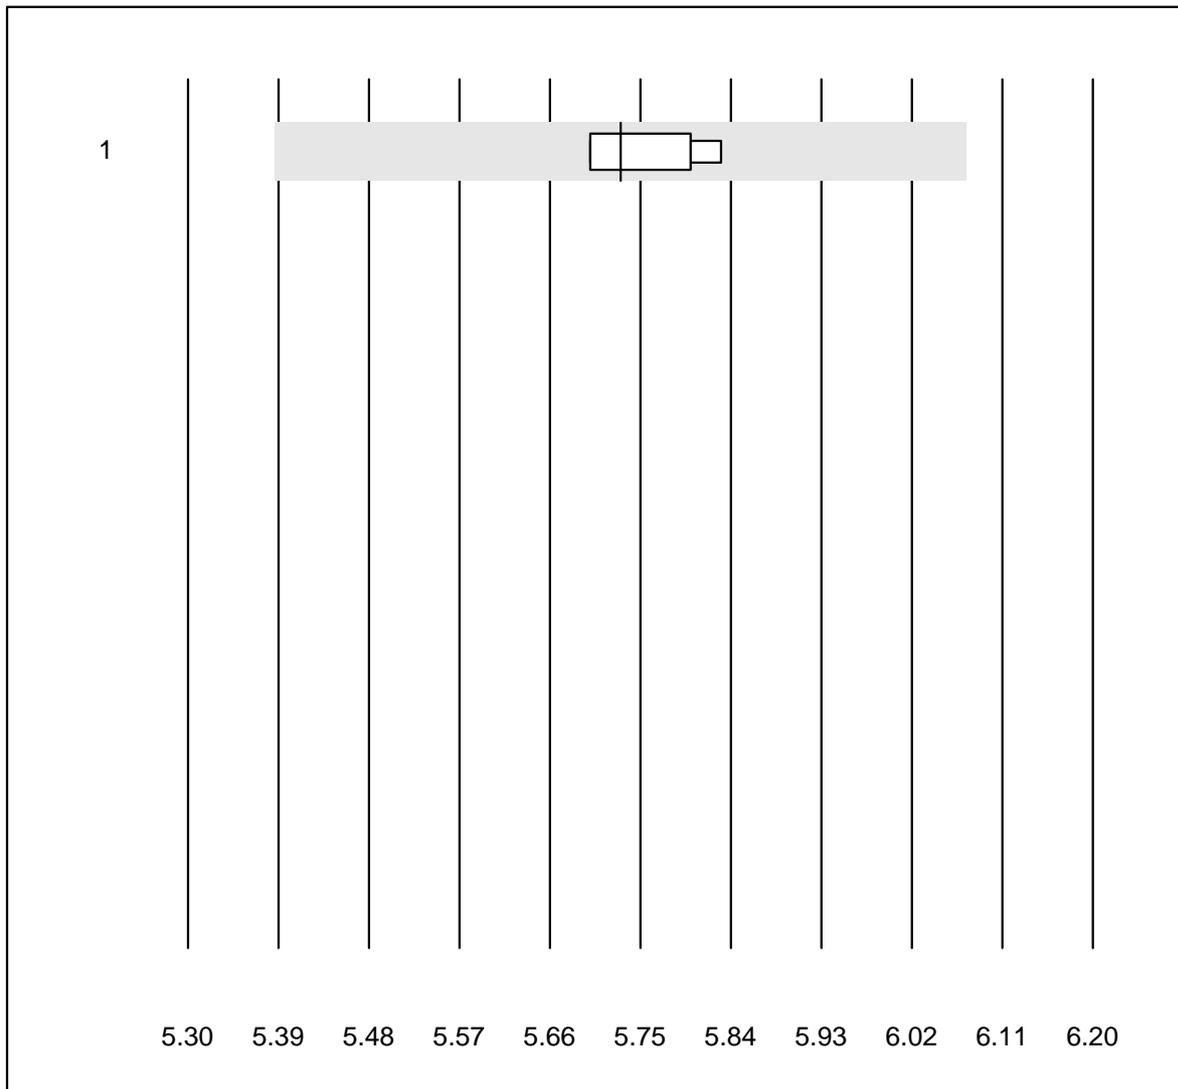


QUALAB Toleranz : 6 %

Potassium CCA (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 OPTI CCA	5	100.0	0.0	0.0	5.7	1.0	e

Sodium CCA

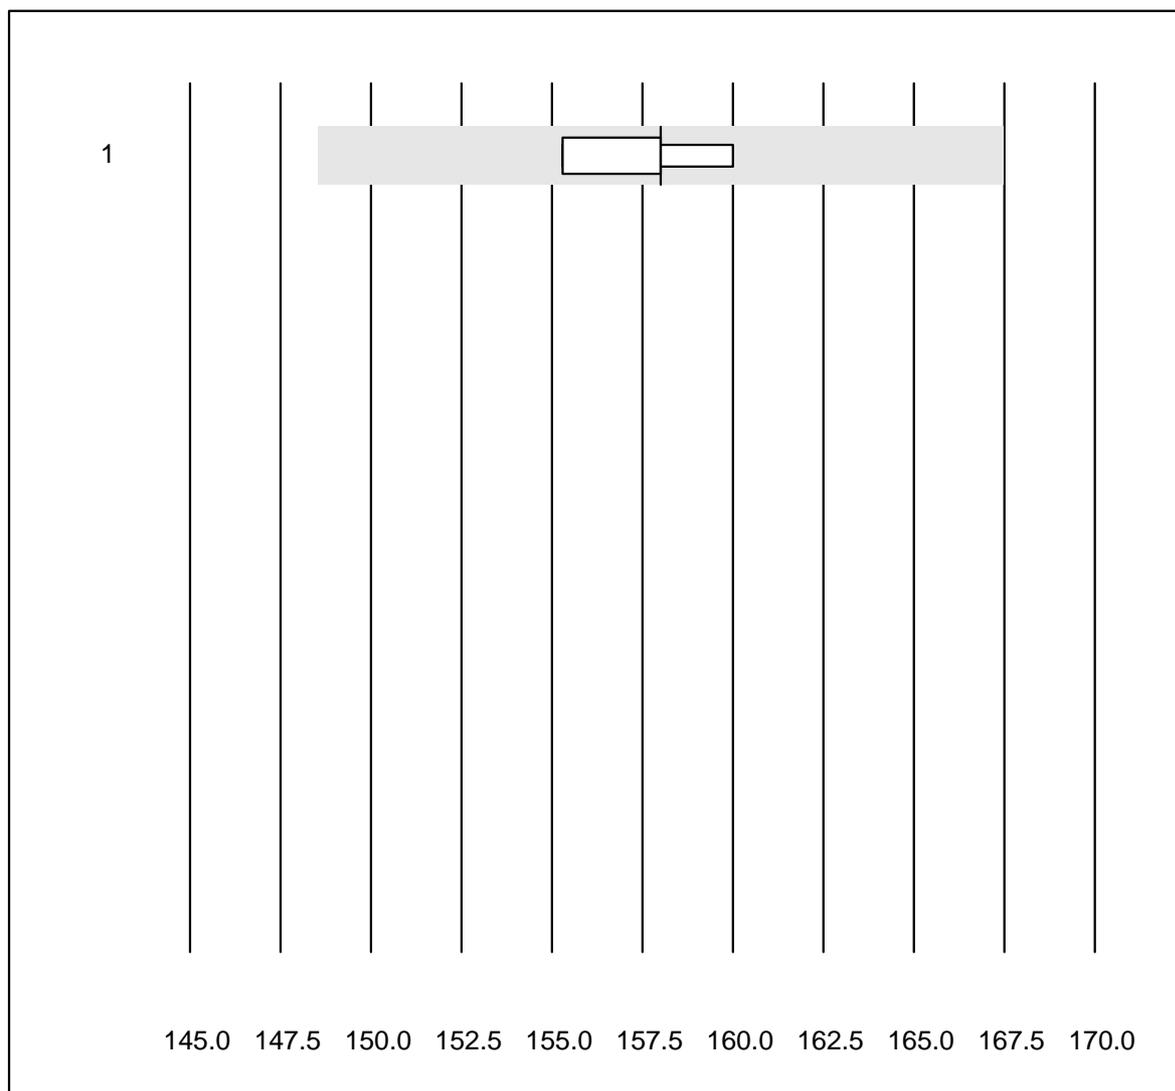


QUALAB Toleranz : 6 %

Sodium CCA (mmol/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 OPTI CCA	4	100.0	0.0	0.0	158.0	1.2	e

Ferritine

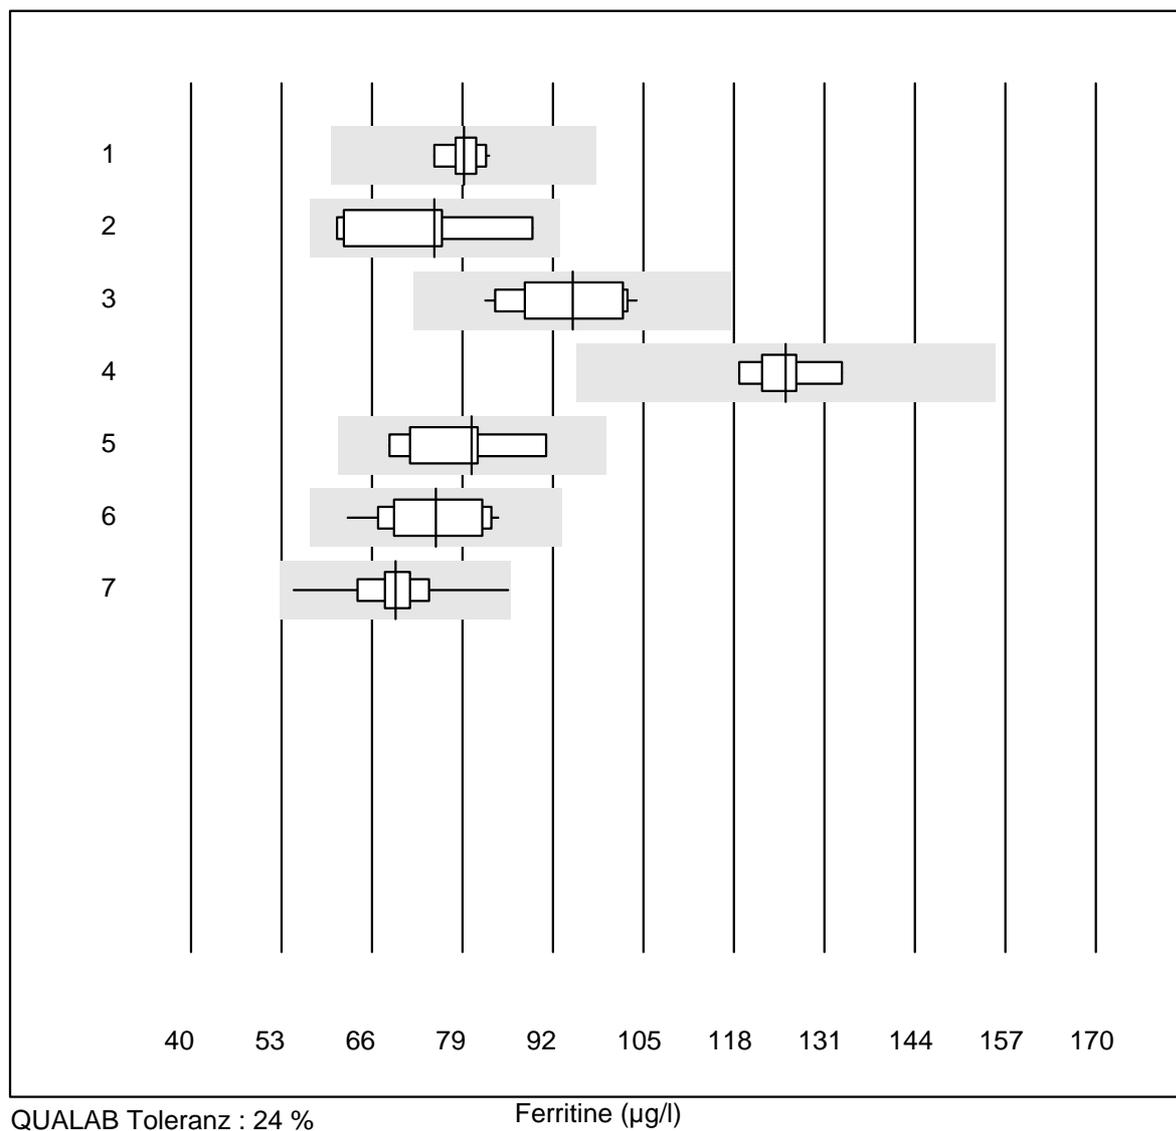

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Beckman	10	100.0	0.0	0.0	79.18	3.2	e
2	toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	75.00	14.2	e*
3	Cobas E / Elecsys	13	100.0	0.0	0.0	94.81	8.4	e
4	Architect	8	100.0	0.0	0.0	125.48	3.5	e
5	Mini Vidas	8	100.0	0.0	0.0	80.34	8.8	e*
6	AFIAS	42	100.0	0.0	0.0	75.21	9.0	e
7	Eurolyser	23	95.7	0.0	4.3	69.38	8.9	e

Vitamine B12

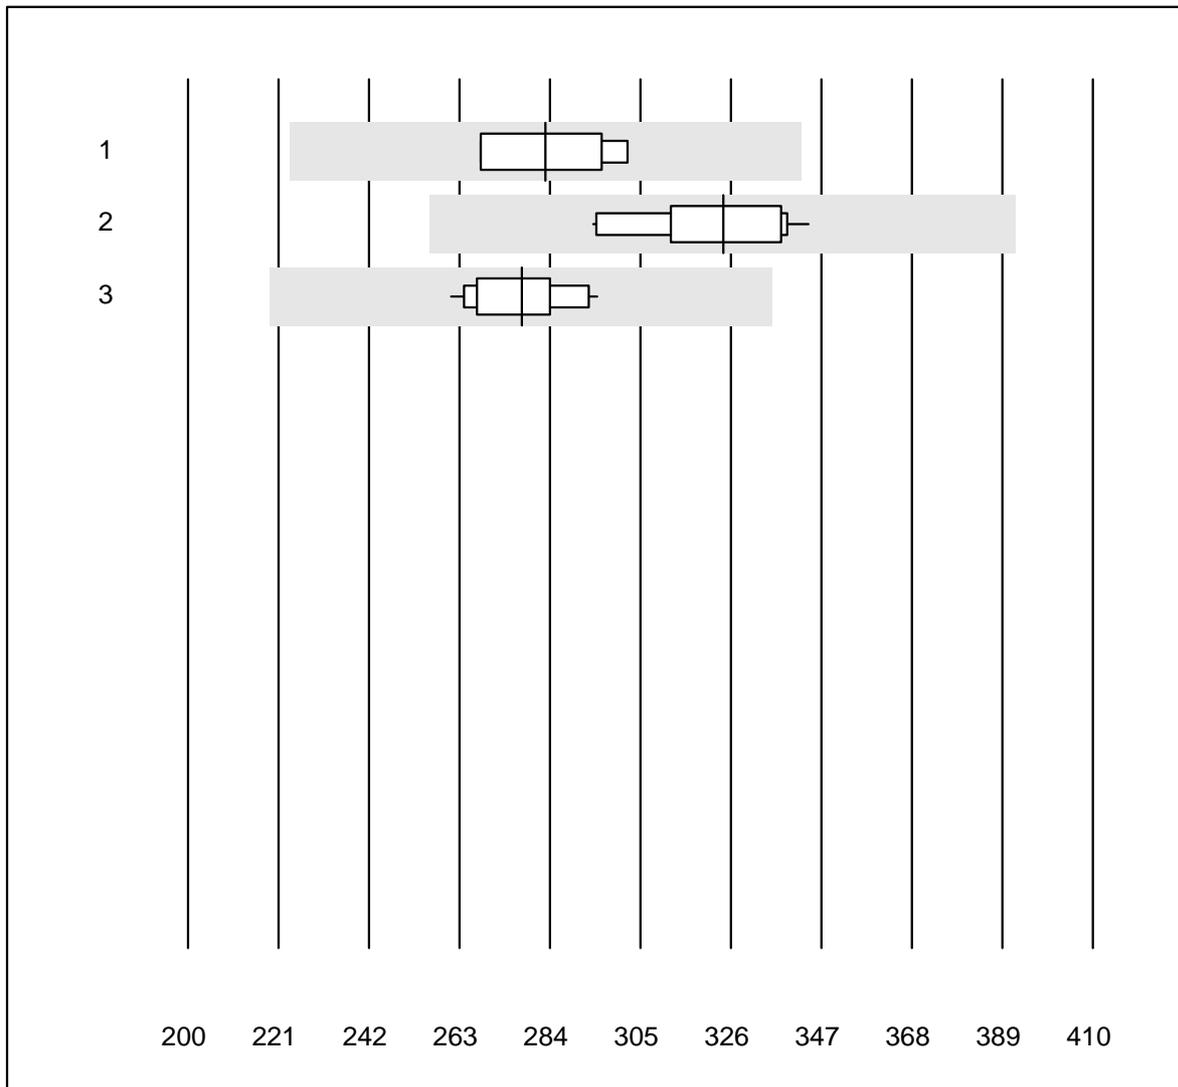


QUALAB Toleranz : 21 %

Vitamine B12 (pmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	283.00	6.2	e*
2 Cobas E / Elecsys	12	100.0	0.0	0.0	324.17	5.1	e
3 Architect	12	100.0	0.0	0.0	277.39	4.1	e

Folate

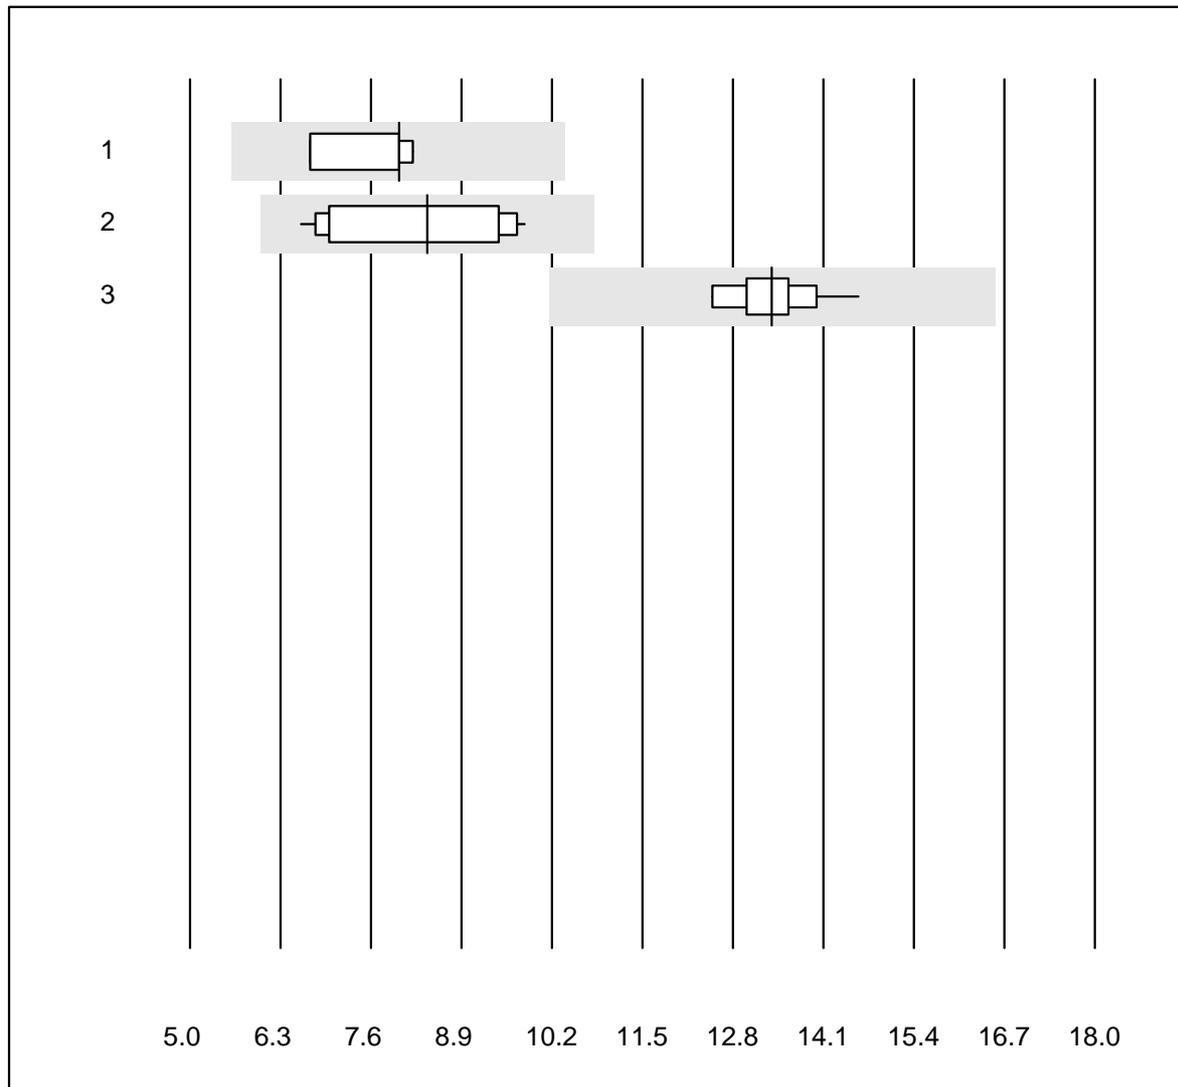


QUALAB Toleranz : 24 %
 (< 10.00: +/- 2.40 nmol/l)

Folate (nmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	8.00	8.7	e*
2 Cobas E / Elecsys	11	100.0	0.0	0.0	8.41	13.8	e*
3 Architect	10	100.0	0.0	0.0	13.36	4.5	e

Holotranscobalamine

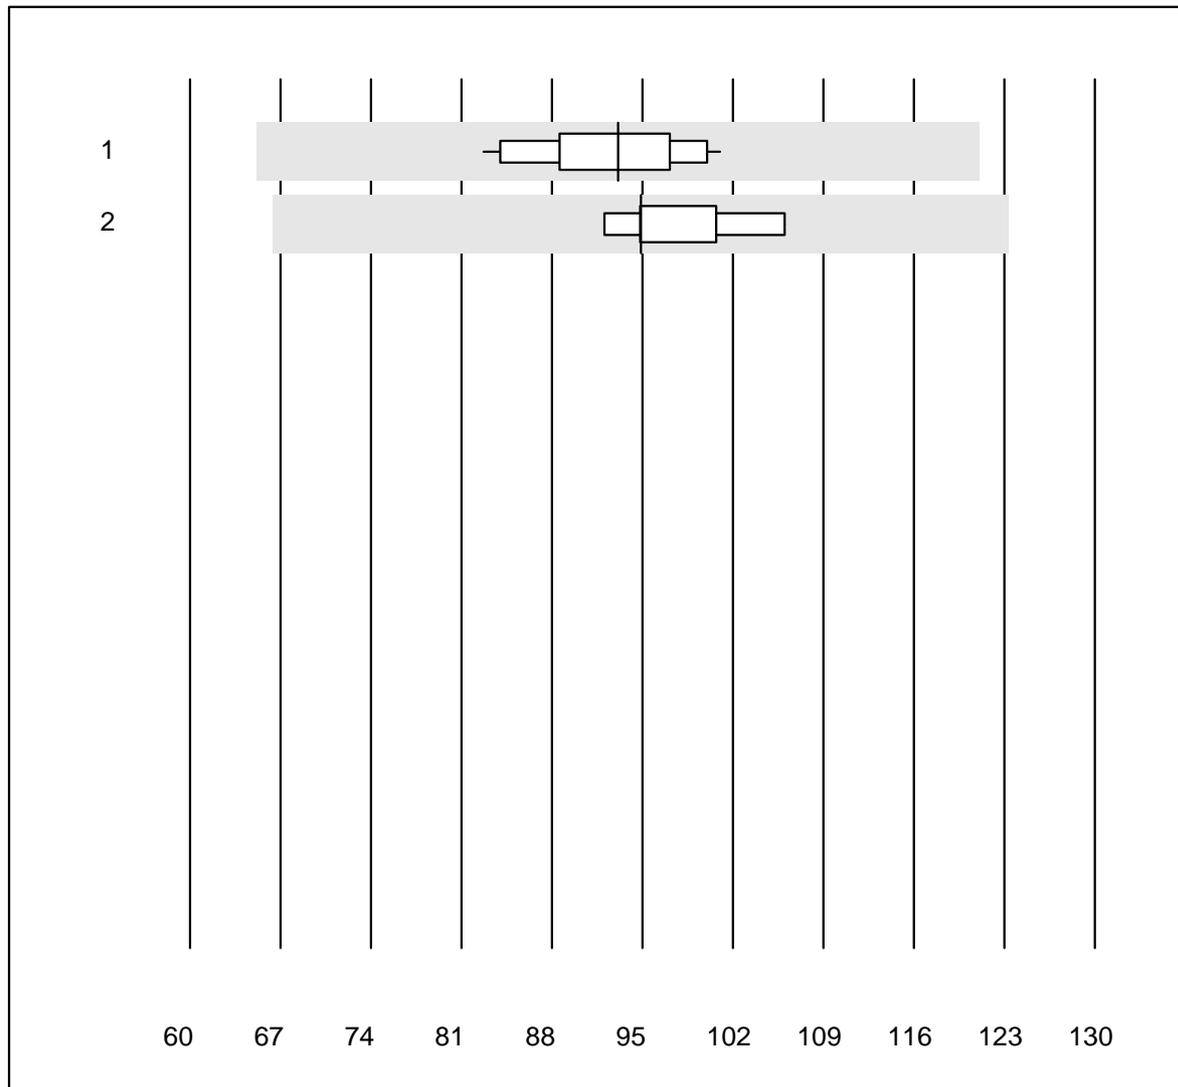

Tolérance MQ : 30 %

Holotranscobalamine (pmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Architect	12	100.0	0.0	0.0	93.1	6.4	e
2	toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	94.9	5.7	e

Bilirubin totale Neo




QUALAB Toleranz : 18 %

Bilirubin totale Neo ($\mu\text{mol/l}$)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	15	100.0	0.0	0.0	227	8.2	e

Bilirubin directe

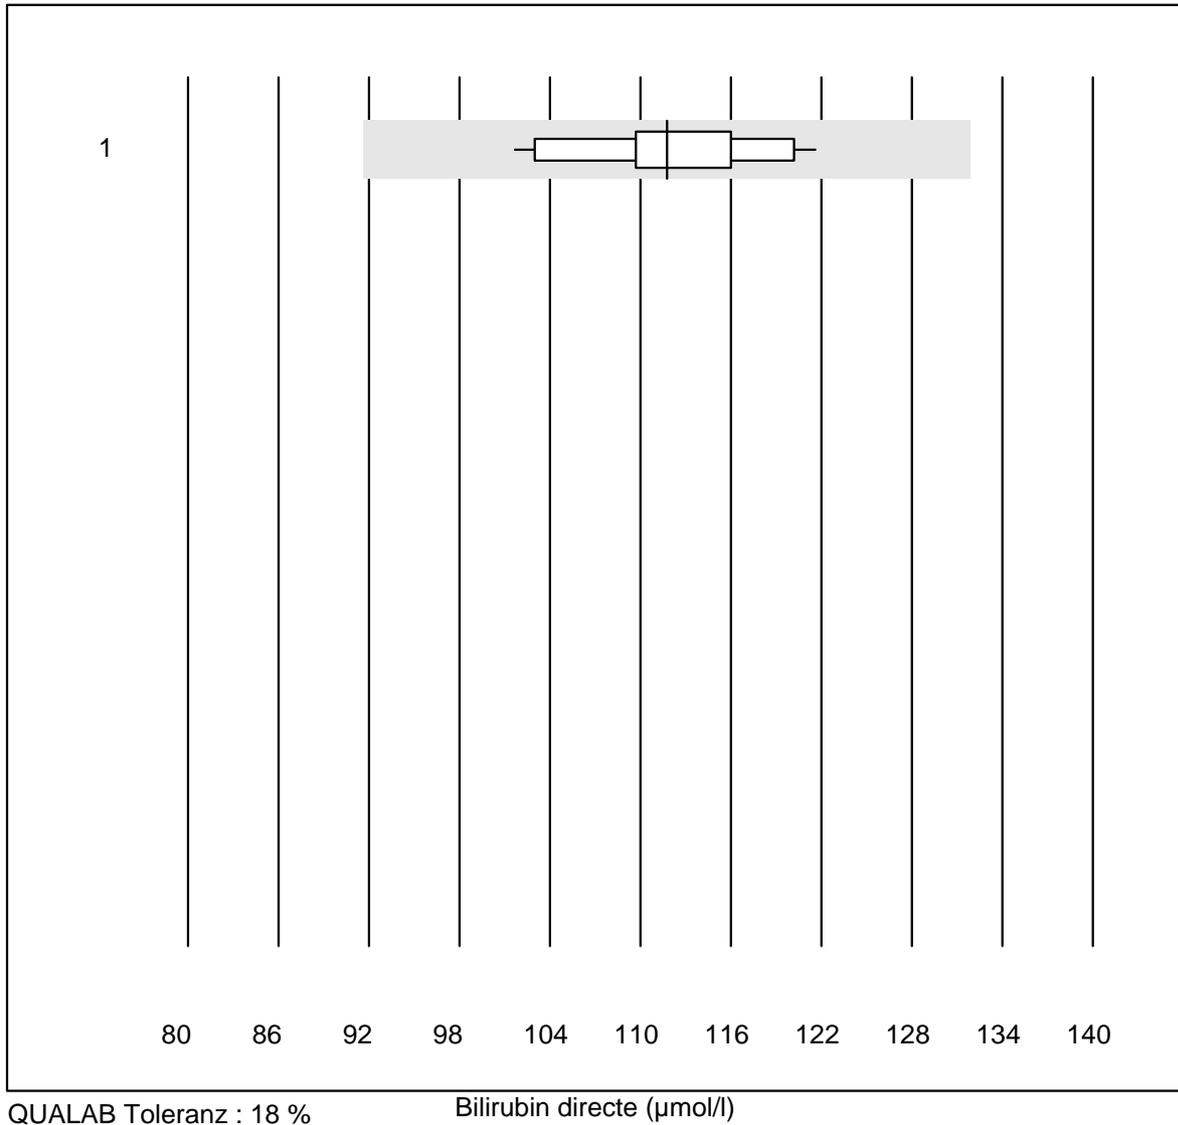


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	18	100.0	0.0	0.0	112	5.2	e

Bilirubin néonatale

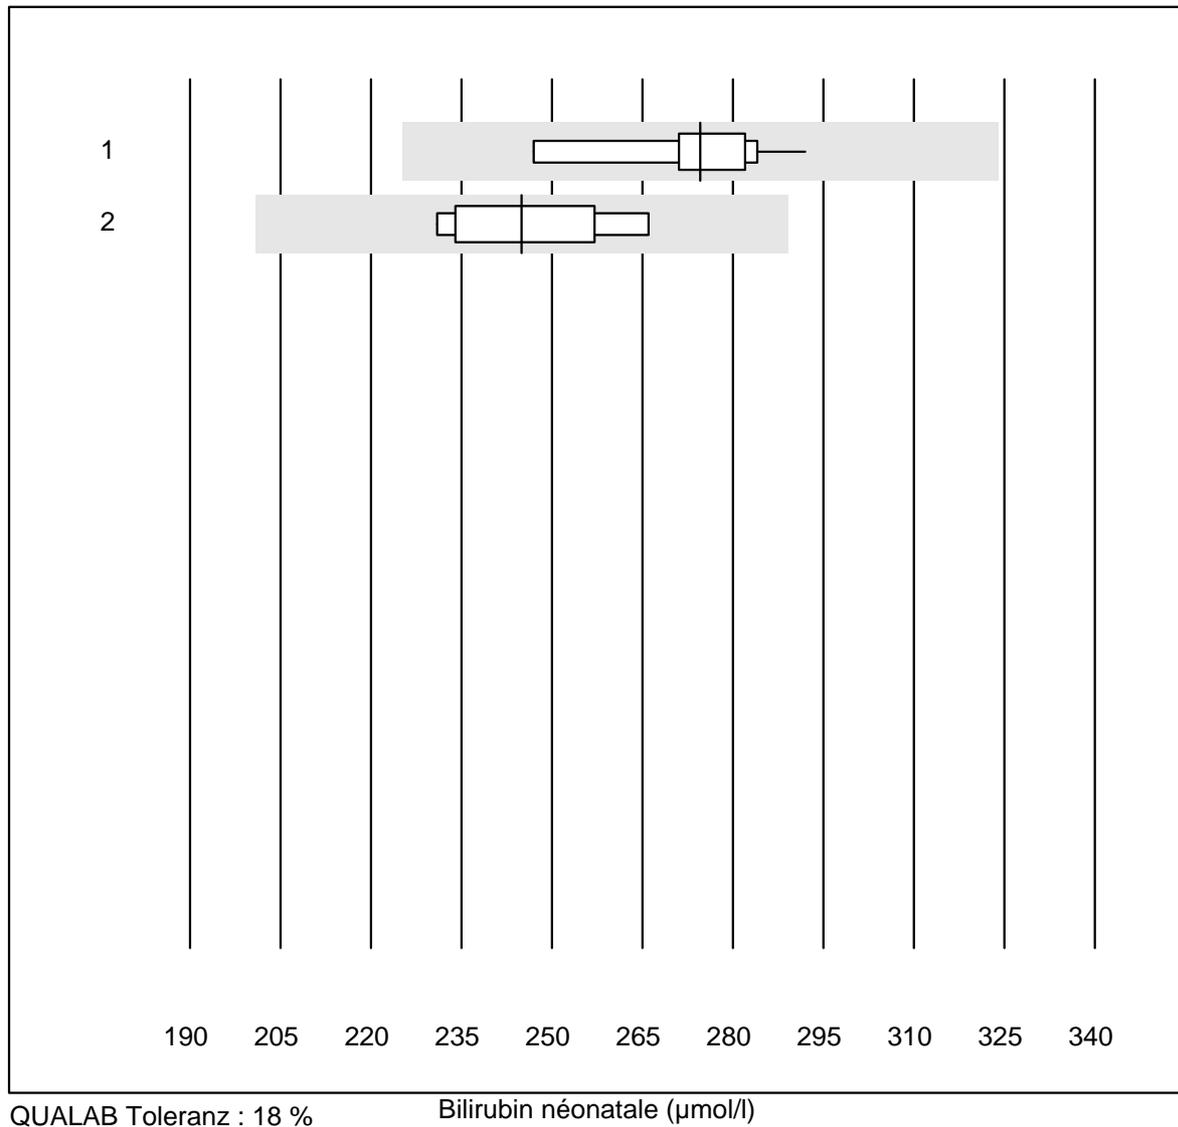

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	10	100.0	0.0	0.0	275	4.7	e
2 ABL700/800	5	100.0	0.0	0.0	245	6.0	e*

PSA

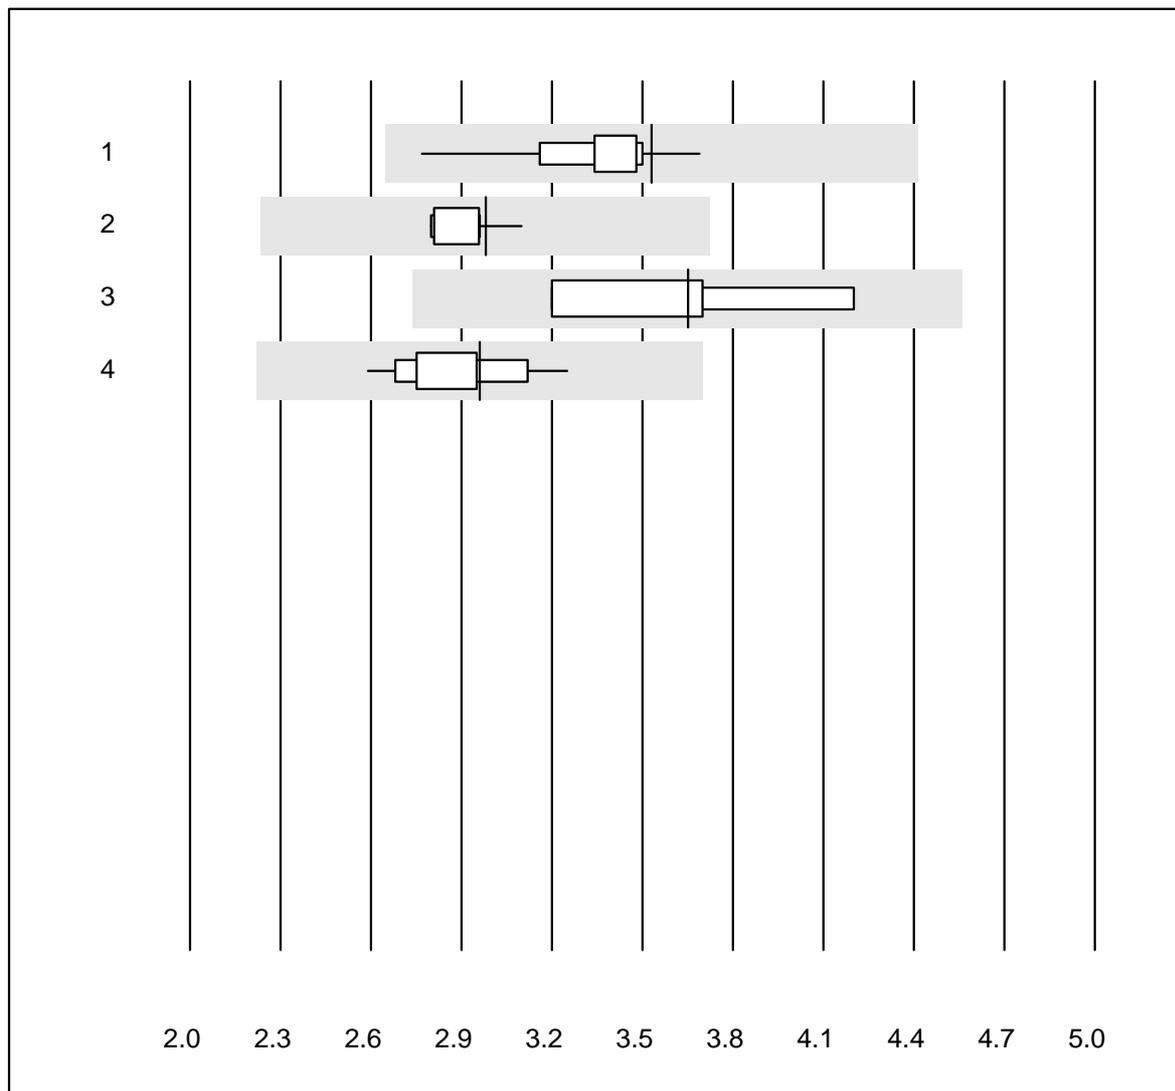


QUALAB Toleranz : 25 %

PSA (µg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	11	100.0	0.0	0.0	3.53	7.0	a
2	Architect	10	100.0	0.0	0.0	2.98	3.3	a
3	Qualigen	4	100.0	0.0	0.0	3.65	11.2	e*
4	AFIAS	32	100.0	0.0	0.0	2.96	6.1	a

PSA frei

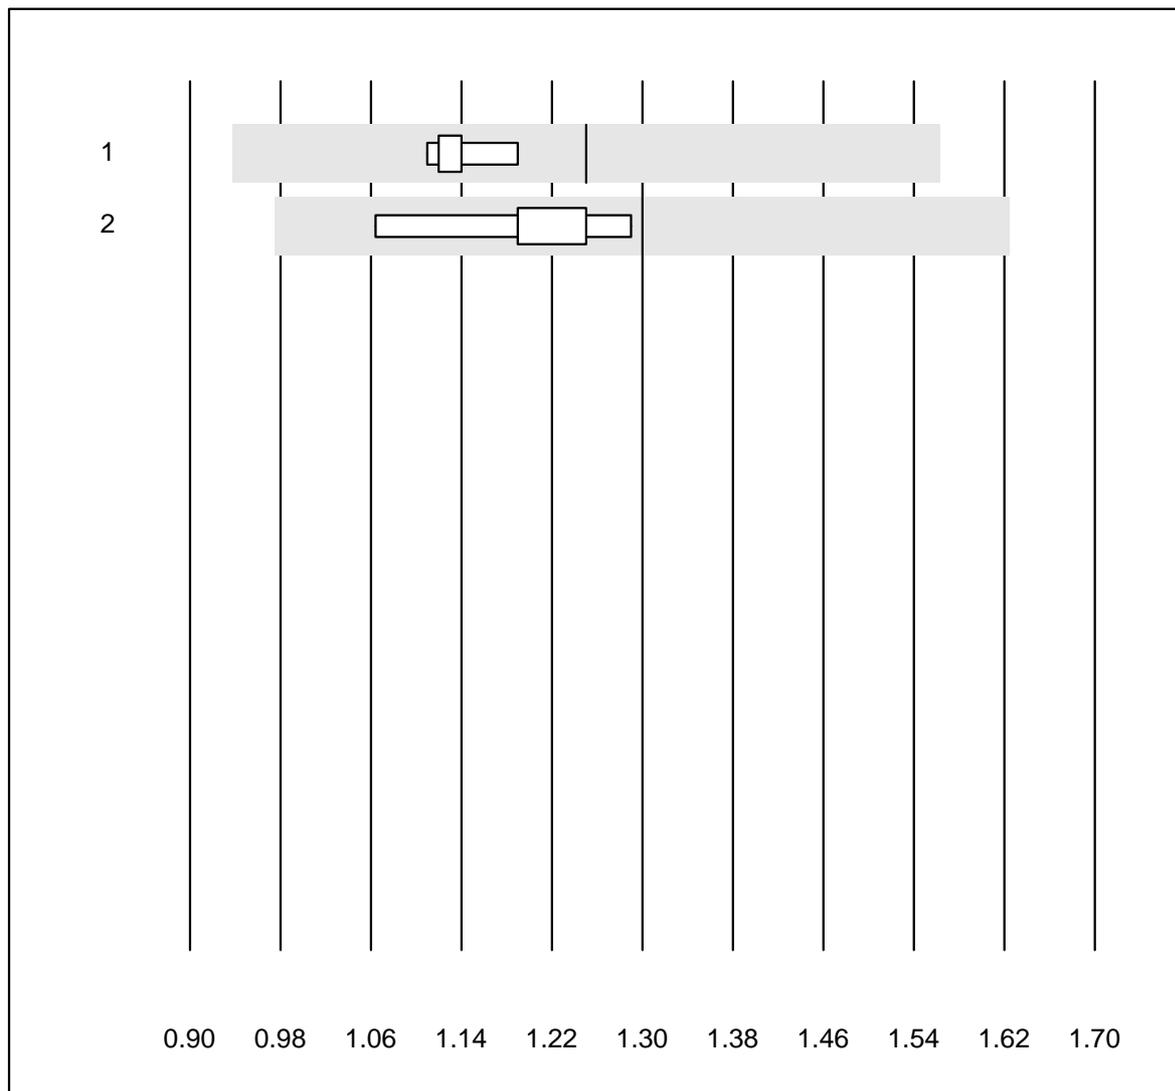


QUALAB Toleranz : 25 %

PSA frei (µg/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	6	100.0	0.0	0.0	1.25	2.4	a
2 Architect	8	100.0	0.0	0.0	1.30	5.8	a

CEA

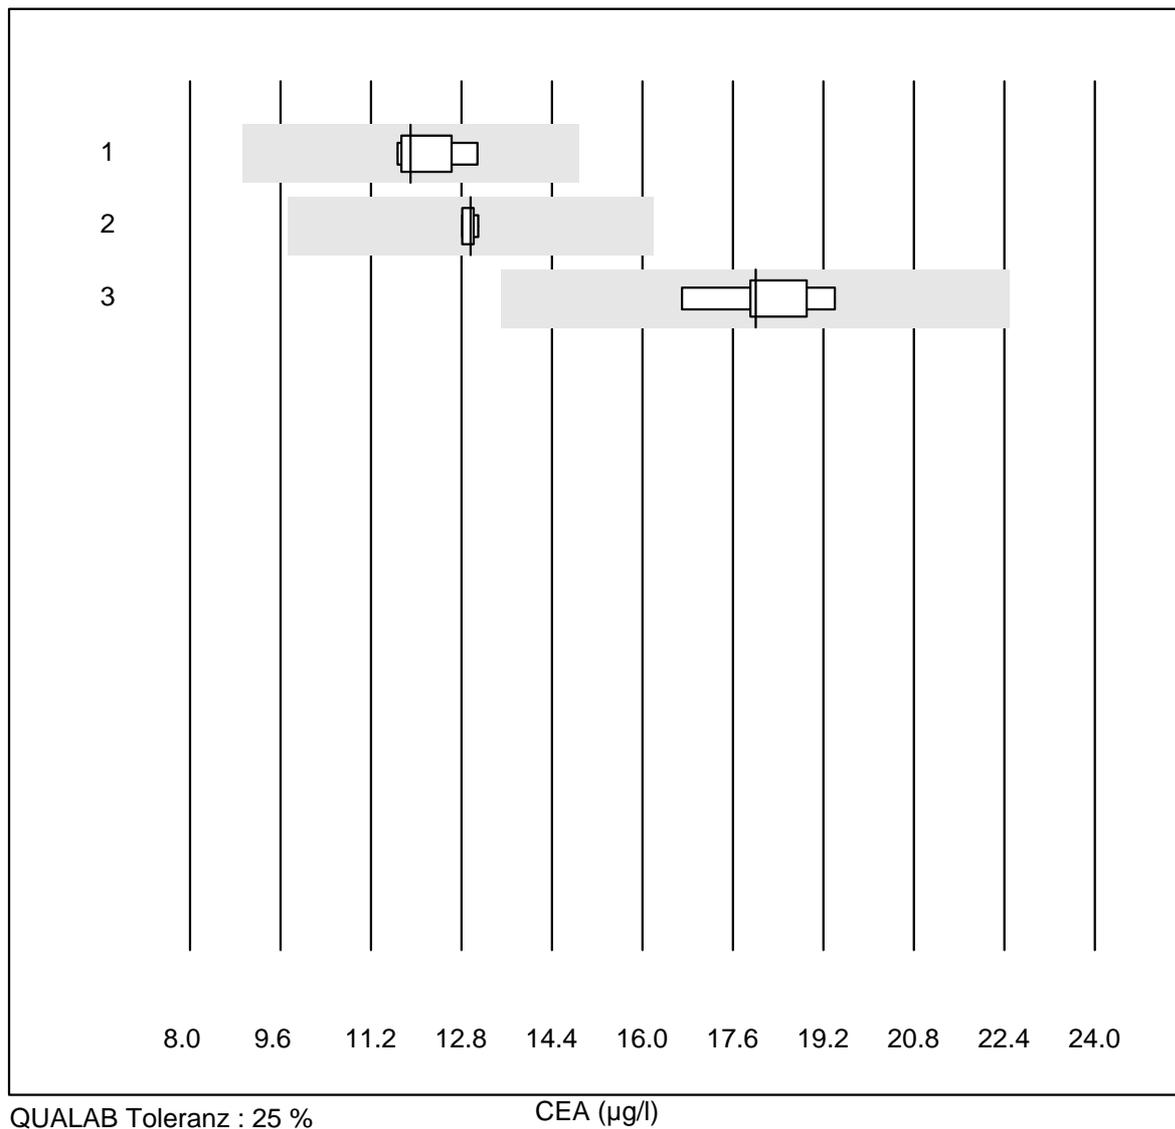

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	7	100.0	0.0	0.0	11.9	4.1	a
2	ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	13.0	1.0	e
3	Architect	6	100.0	0.0	0.0	18.0	5.1	a

CA 125

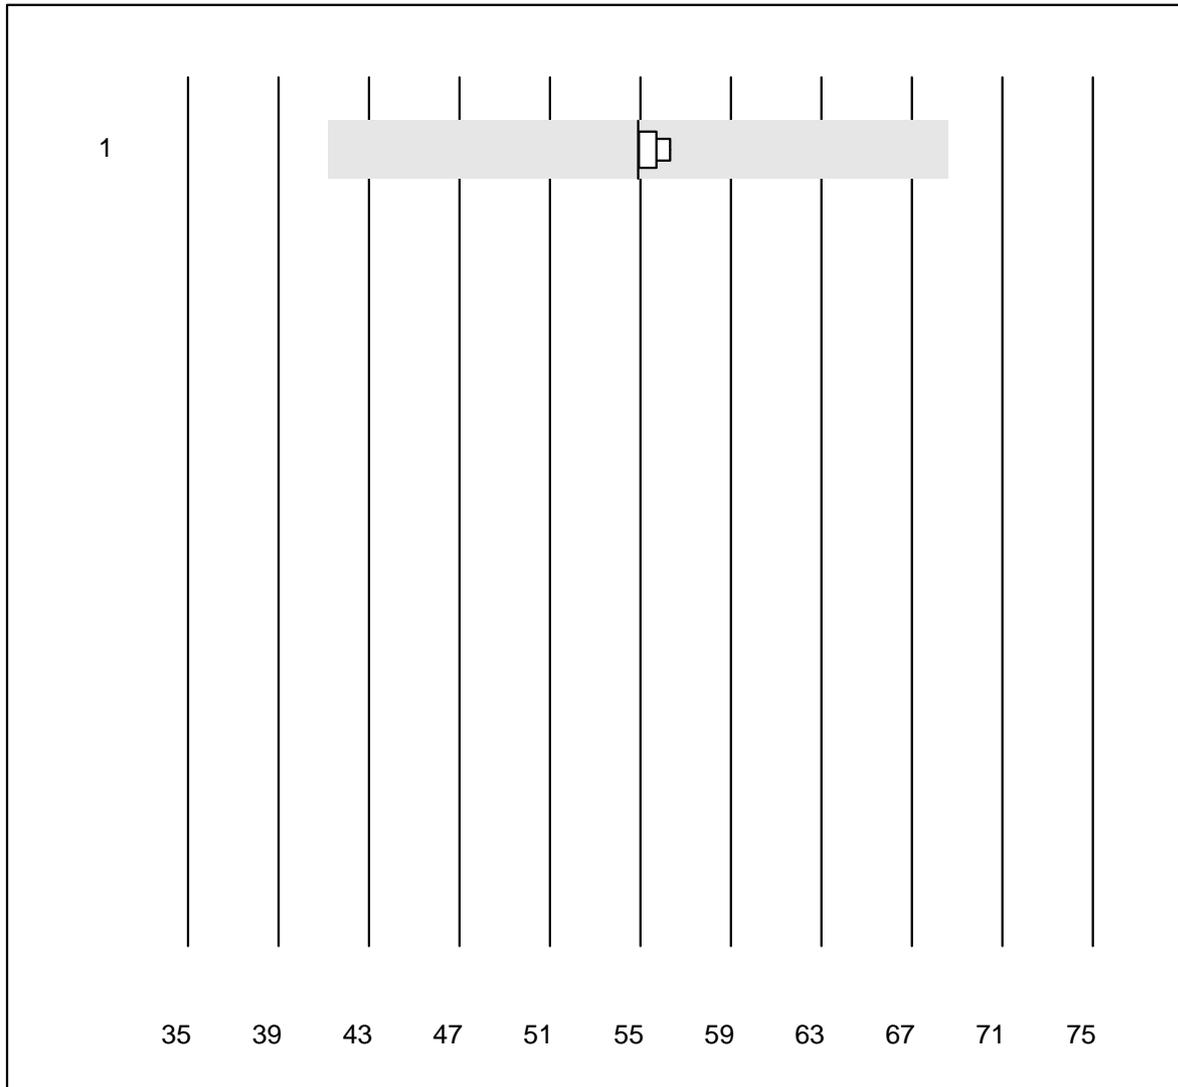


Tolérance MQ : 25 %

CA 125 (kIU/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Architect	4	100.0	0.0	0.0	54.9	1.2	a

CA 15-3

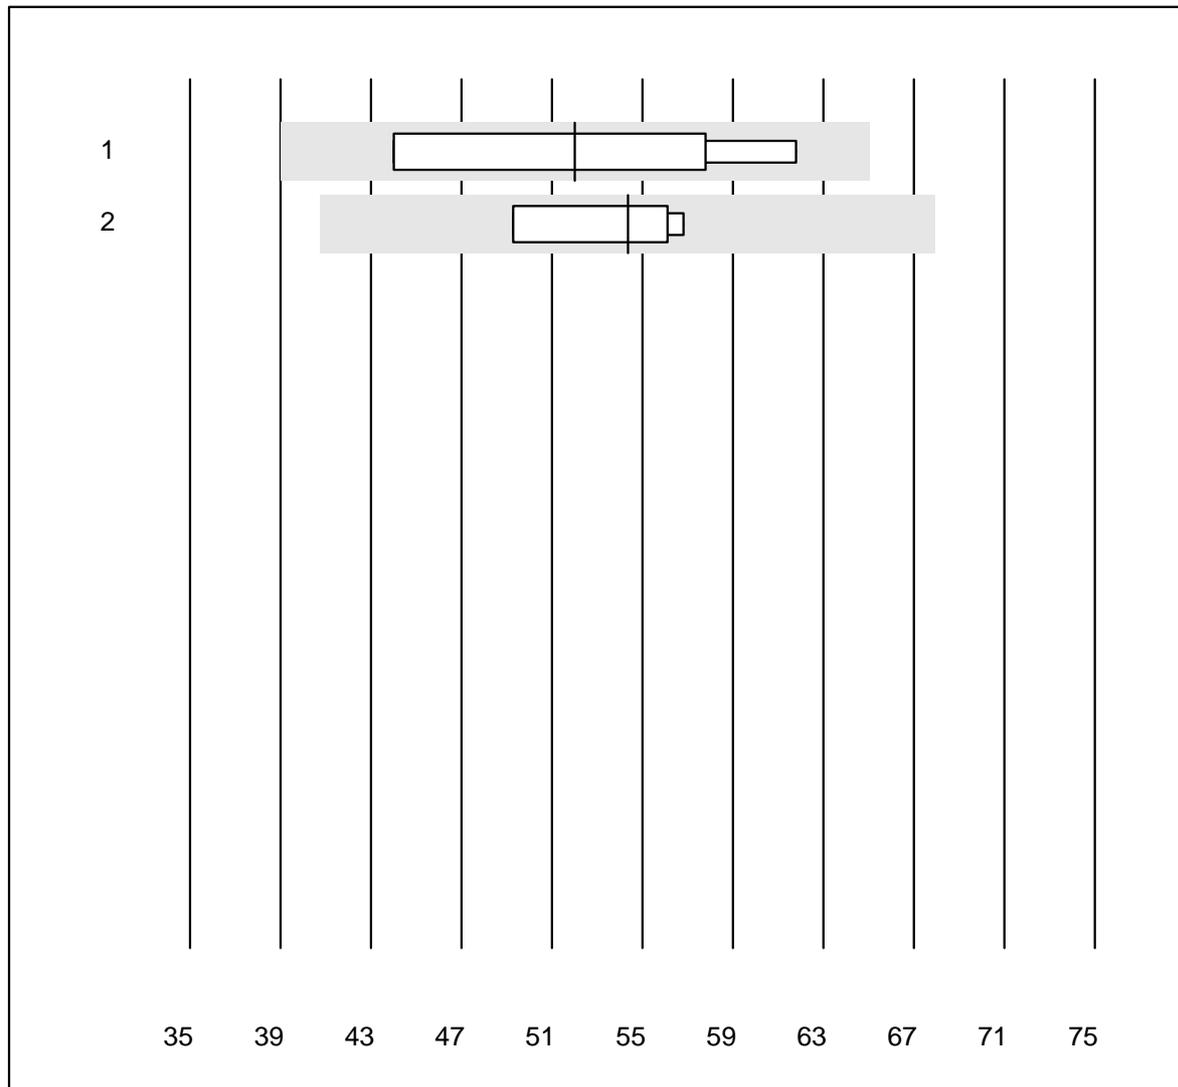


Tolérance MQ : 25 %

CA 15-3 (kIU/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	4	100.0	0.0	0.0	52.0	16.6	a
2	Architect	4	100.0	0.0	0.0	54.4	6.4	e*

AFP

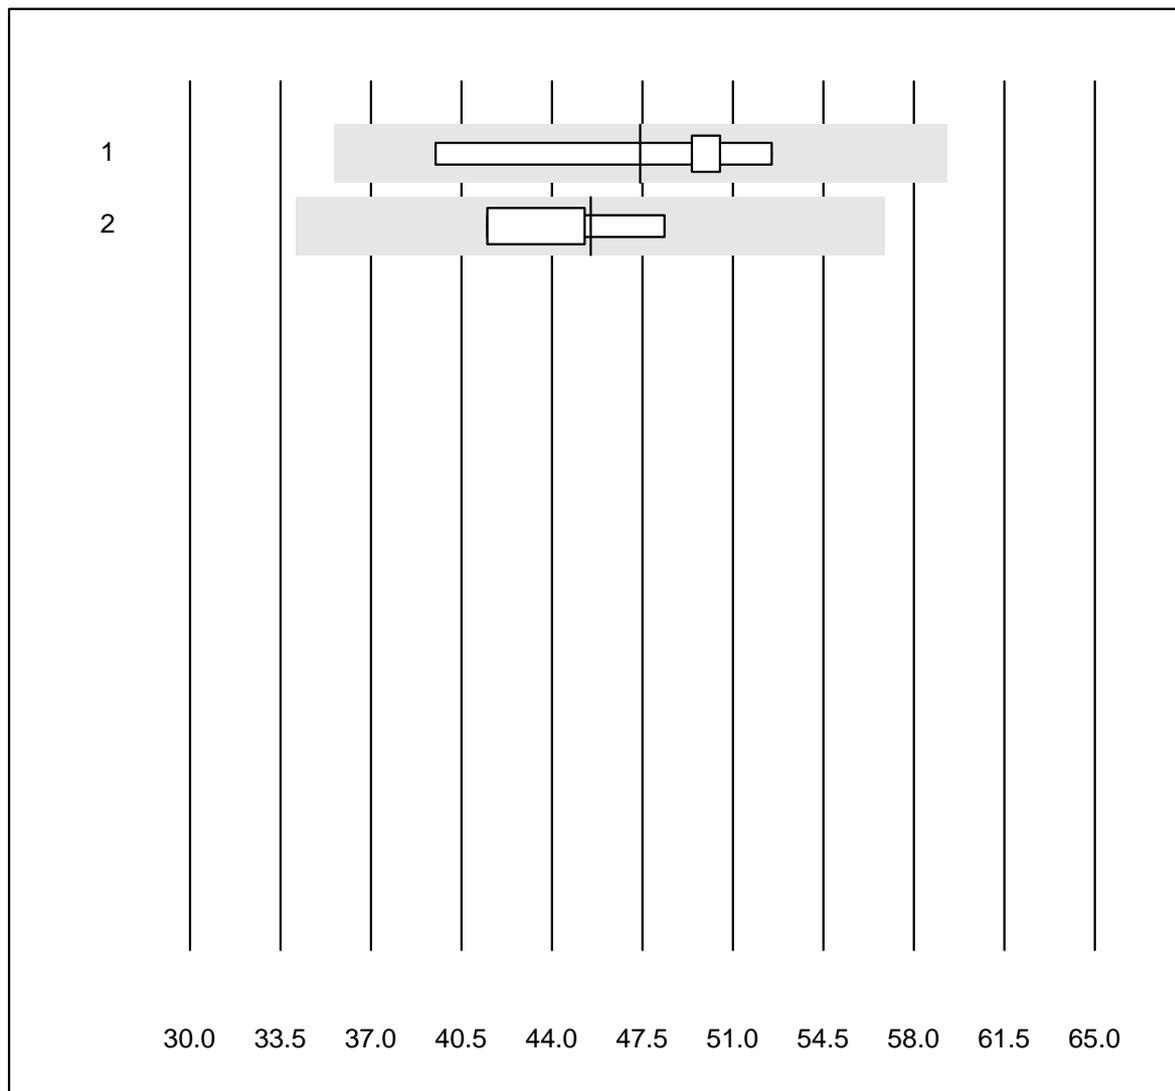


QUALAB Toleranz : 25 %

AFP (µg/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	5	100.0	0.0	0.0	47.4	10.5	a
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	45.5	6.7	a

HCG qn

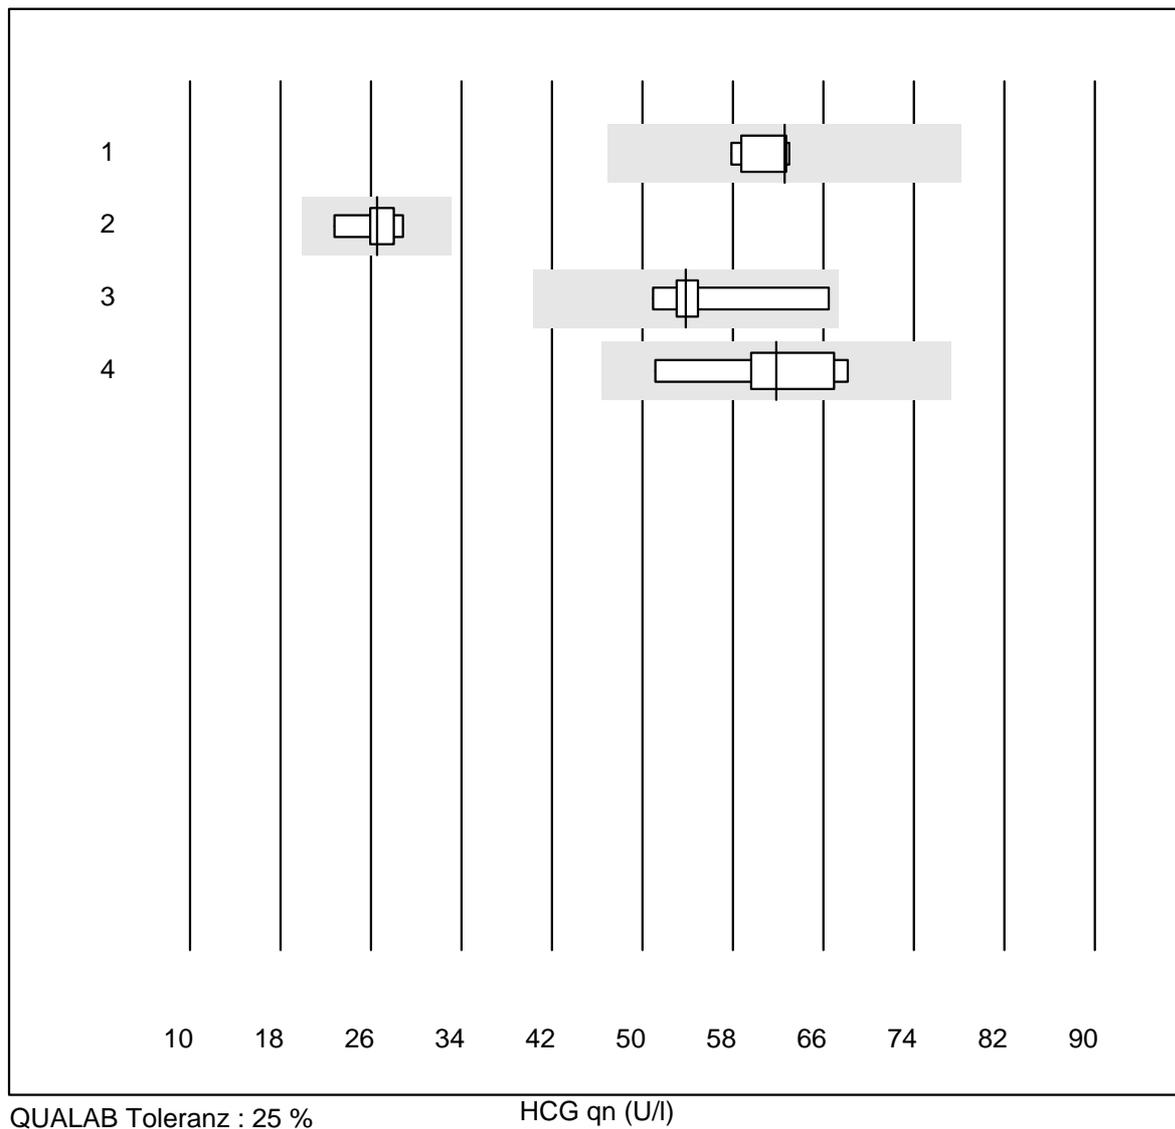


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	6	100.0	0.0	0.0	62.6	3.6	a
2 VIDAS	8	100.0	0.0	0.0	26.5	7.2	e
3 Architect	7	100.0	0.0	0.0	53.8	9.3	e*
4 AFIAS	10	90.0	0.0	10.0	61.8	8.5	e

CK-MB

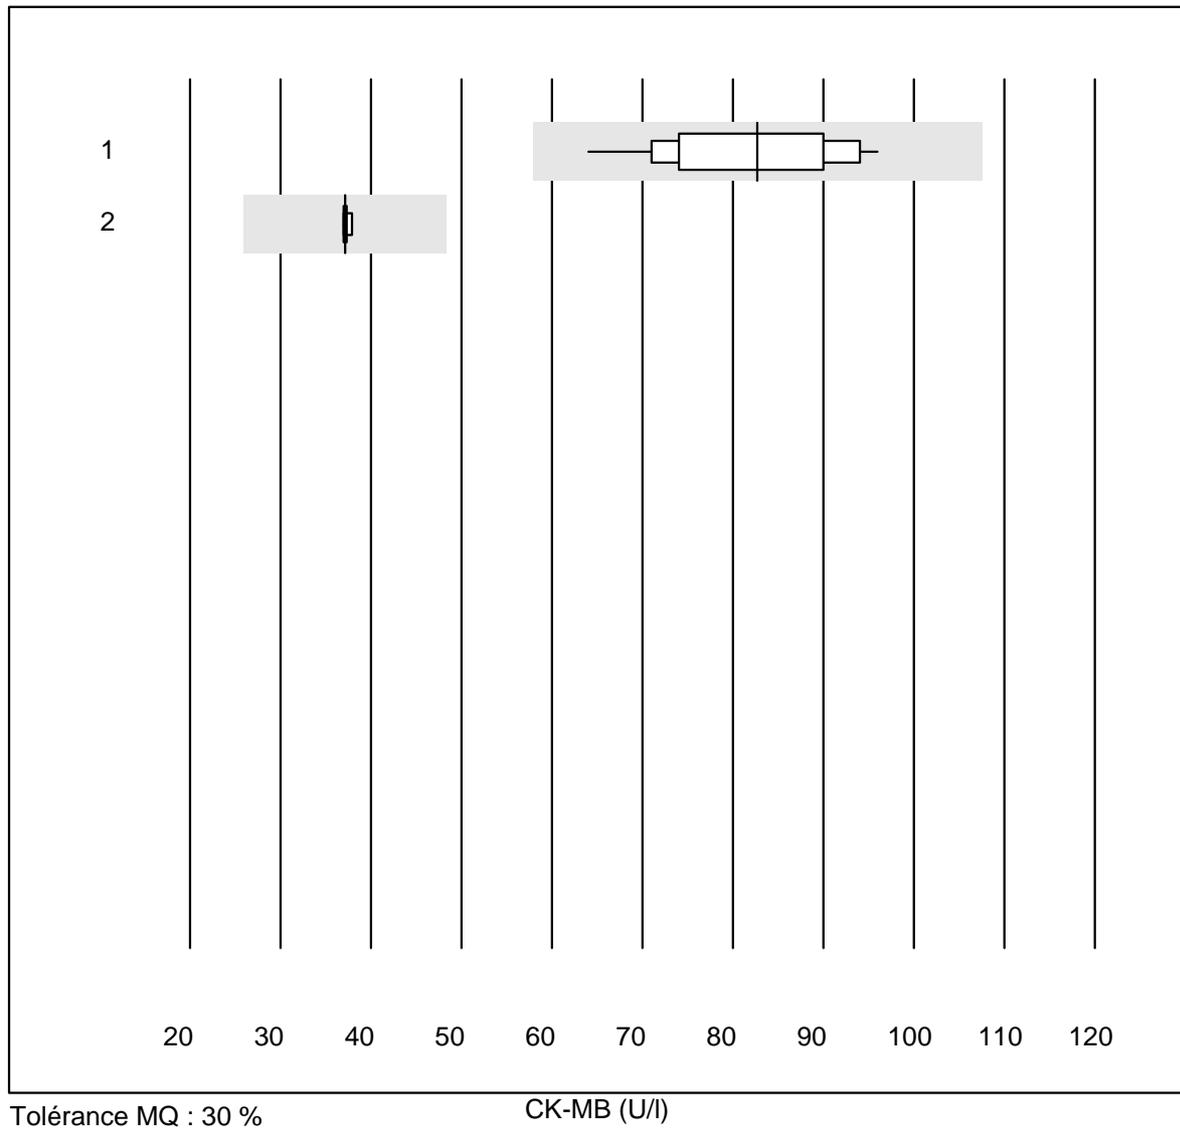


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Fuji Dri-Chem	33	97.0	0.0	3.0	82.7	10.5	e
2	Cobas/Roche	4	100.0	0.0	0.0	37.2	1.1	e

BNP

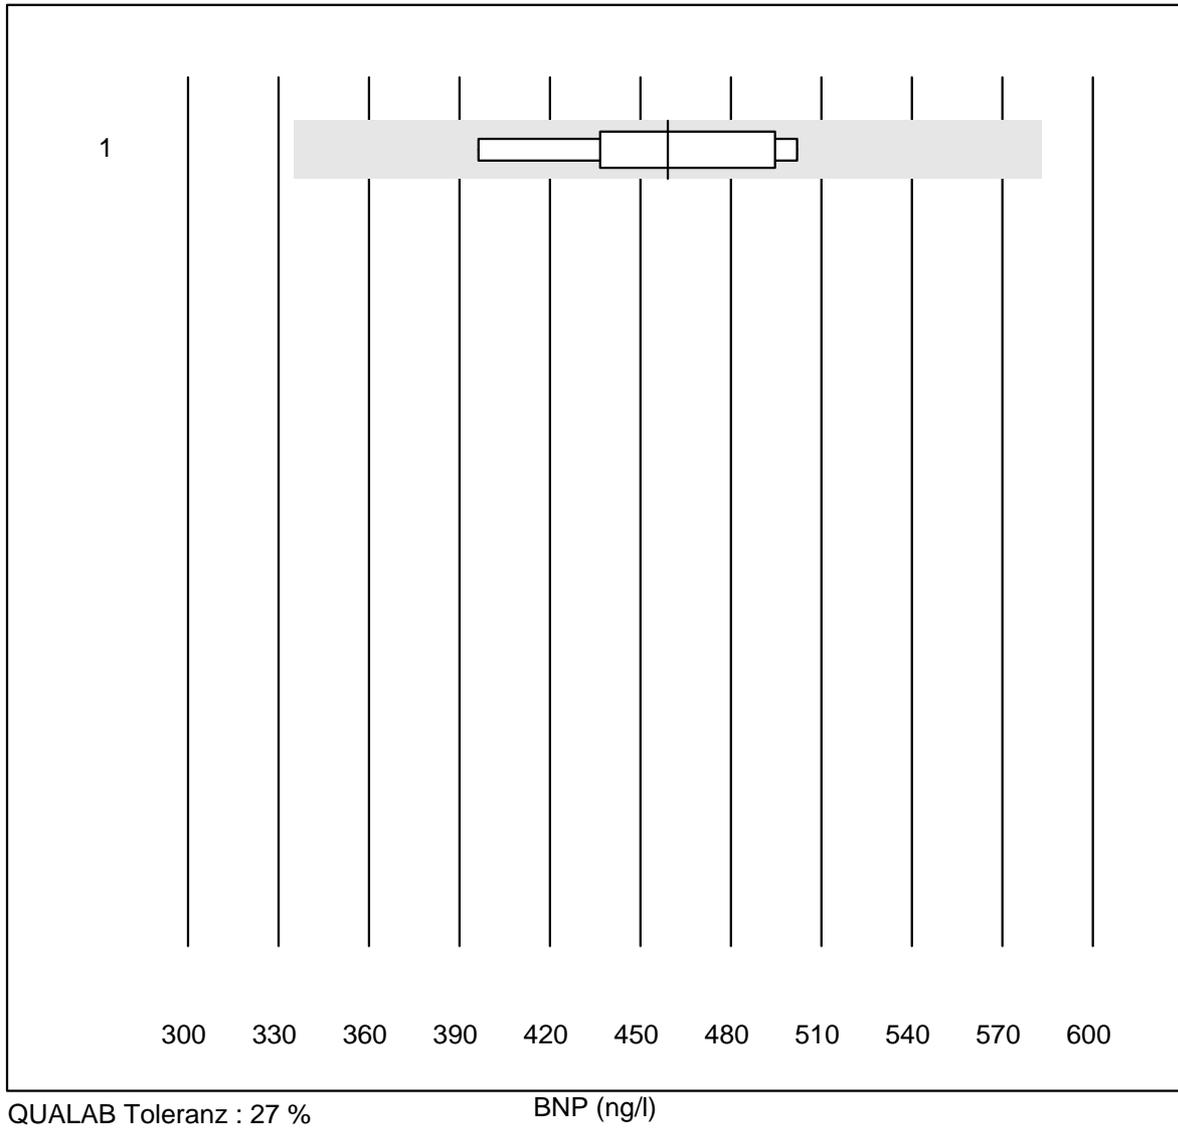

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Architect	5	100.0	0.0	0.0	459.0	9.5	e*

Cholesterin PTS

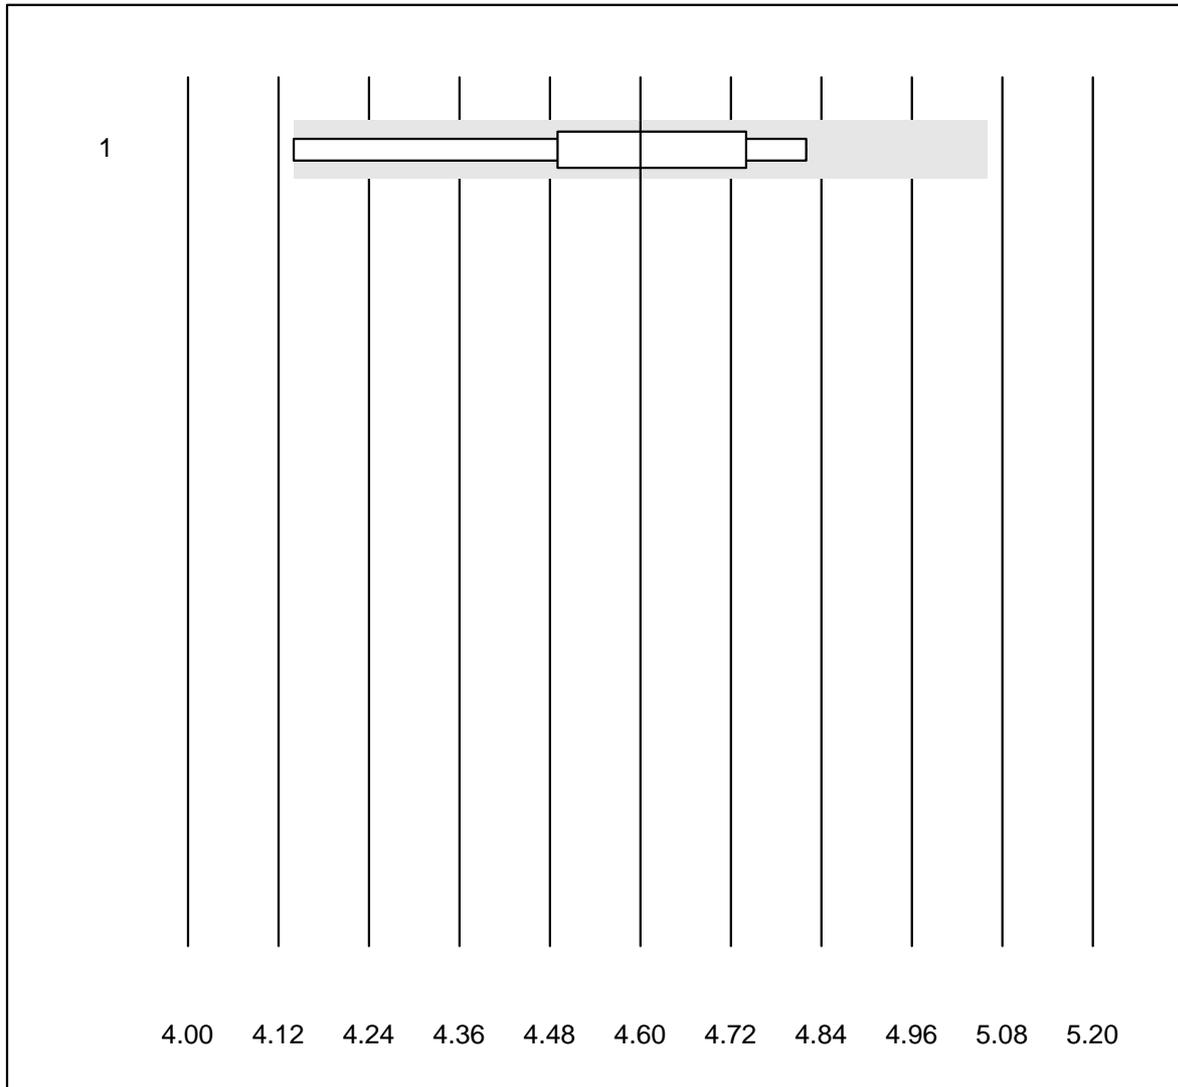


QUALAB Toleranz : 10 %

Cholesterin PTS (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 CardioChek	9	88.9	11.1	0.0	4.60	5.3	e*

Cholesterin HDL PTS

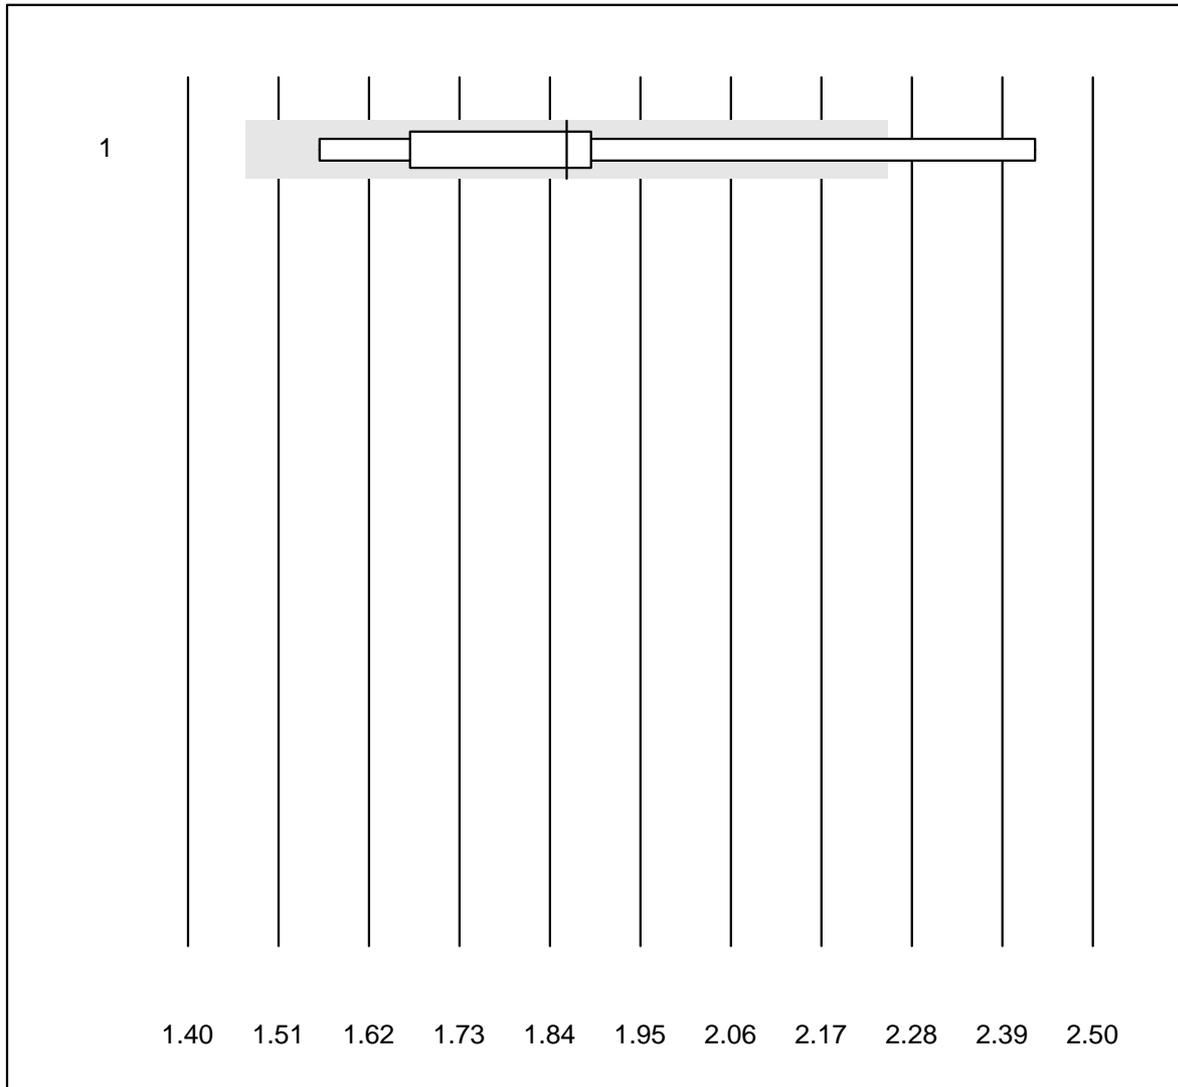


QUALAB Toleranz : 21 %

Cholesterin HDL PTS (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 CardioChek	9	77.8	11.1	11.1	1.86	14.1	e*

Triglyceride PTS

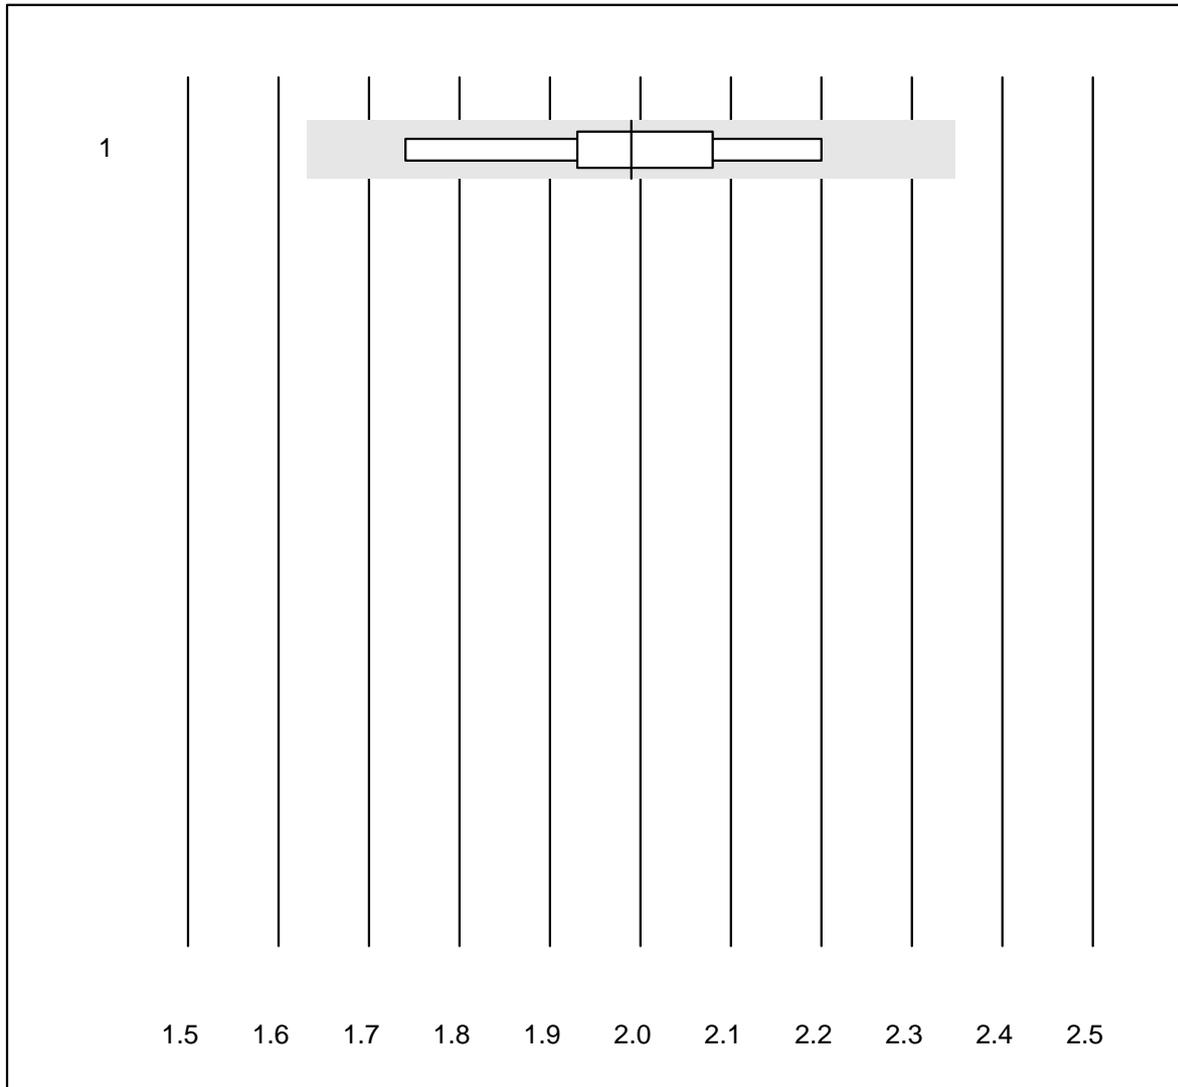


QUALAB Toleranz : 18 %

Triglyceride PTS (mmol/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 CardioChek	9	100.0	0.0	0.0	1.99	7.5	e*

C-Peptid

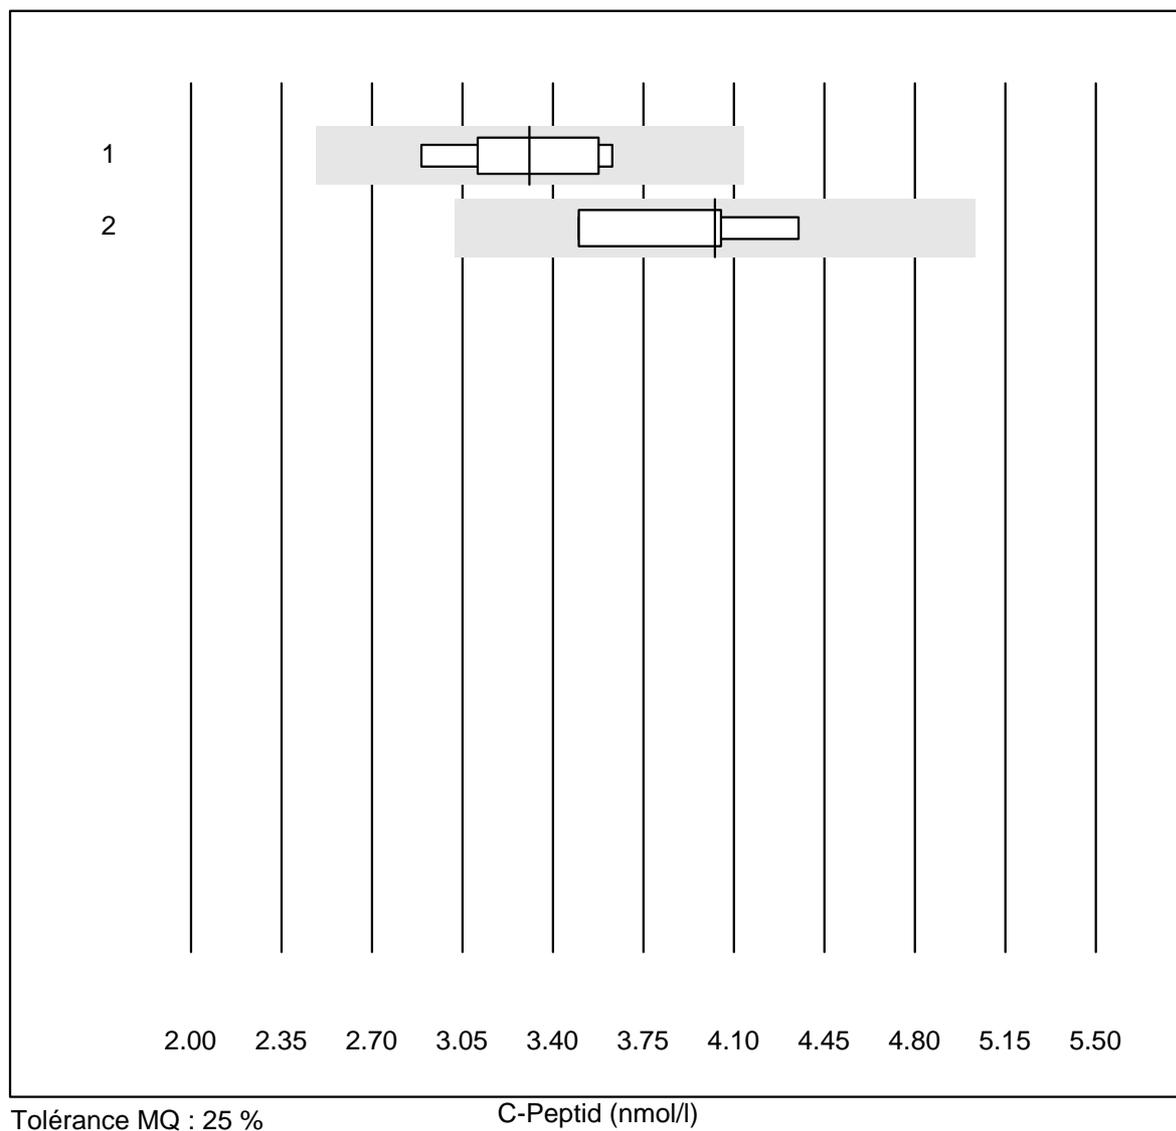


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	3.3	9.4	e*
2 Liaison	4	100.0	0.0	0.0	4.0	8.9	e*

Procalcitonine

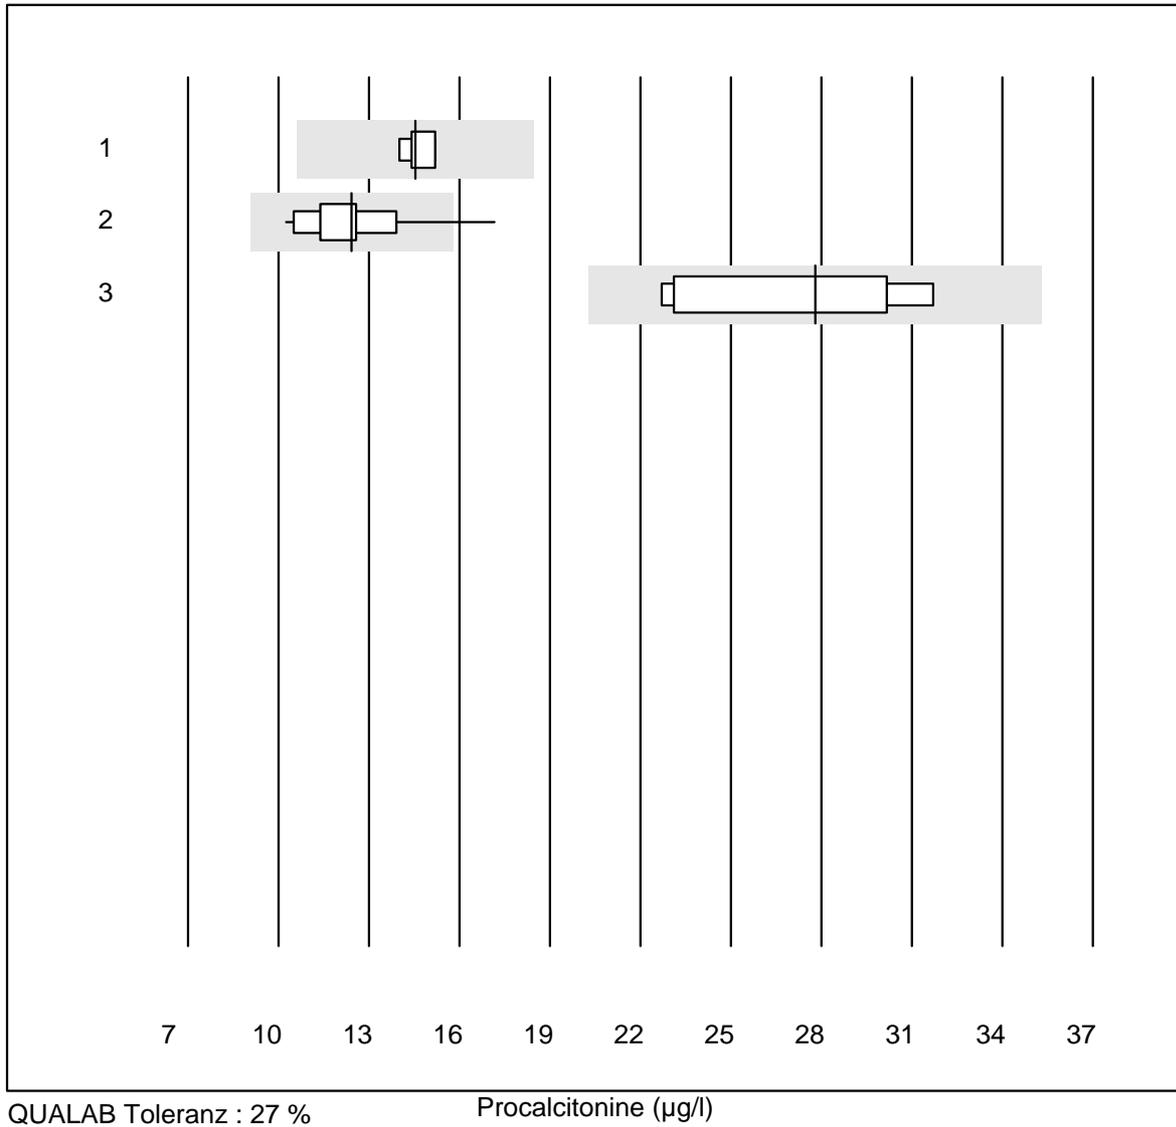

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	14.55	3.5	e
2 VIDAS	19	94.7	5.3	0.0	12.43	12.5	e
3 Liaison	5	100.0	0.0	0.0	27.80	15.0	e*

EPO

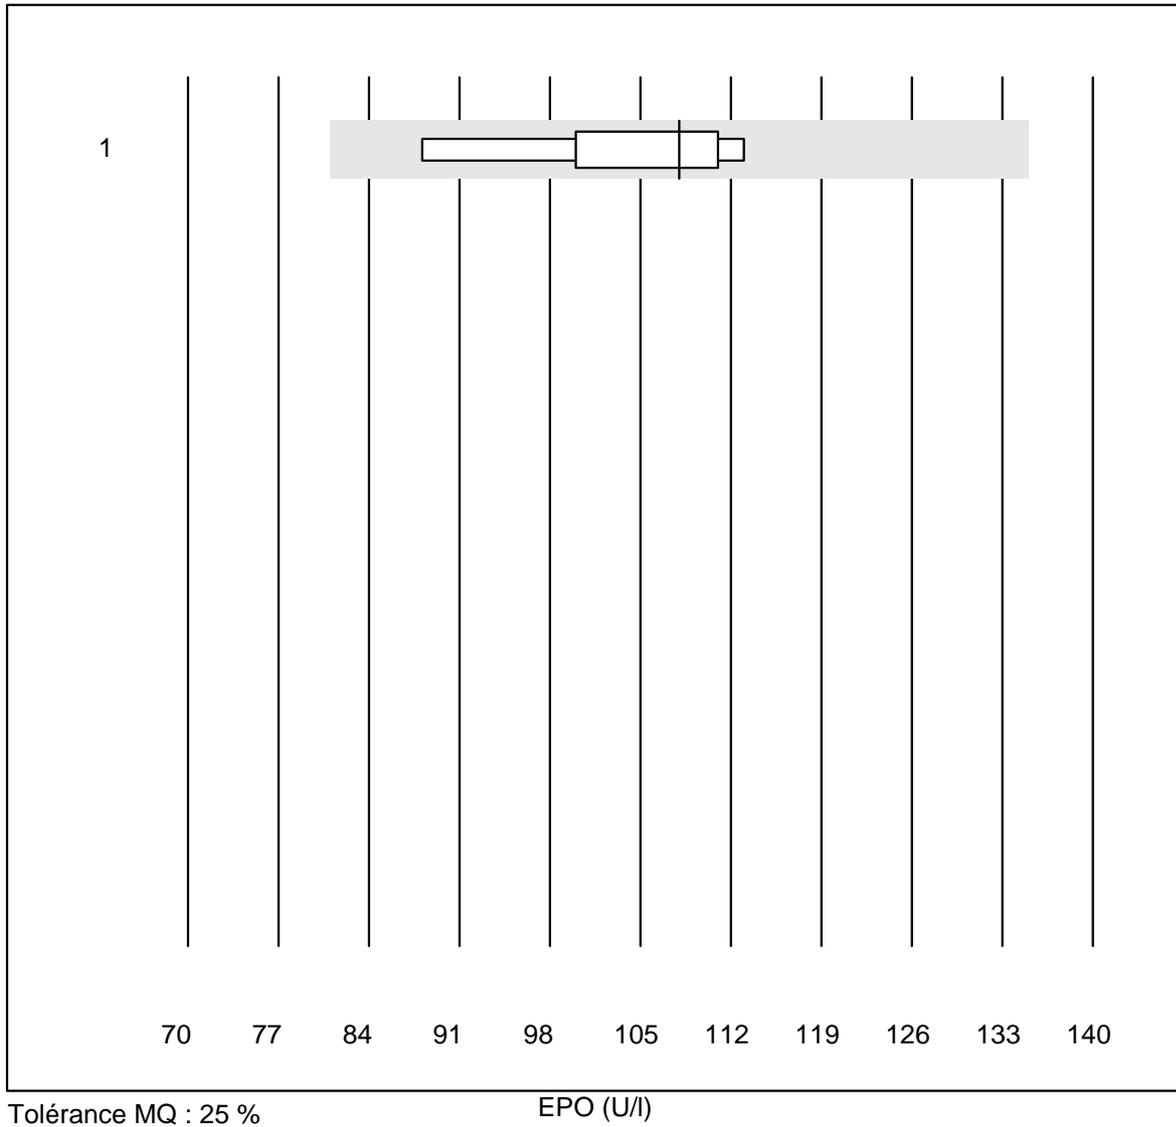


Tolérance MQ : 25 %

EPO (U/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Immulite	5	100.0	0.0	0.0	108.0	9.8	e*

Parathormone

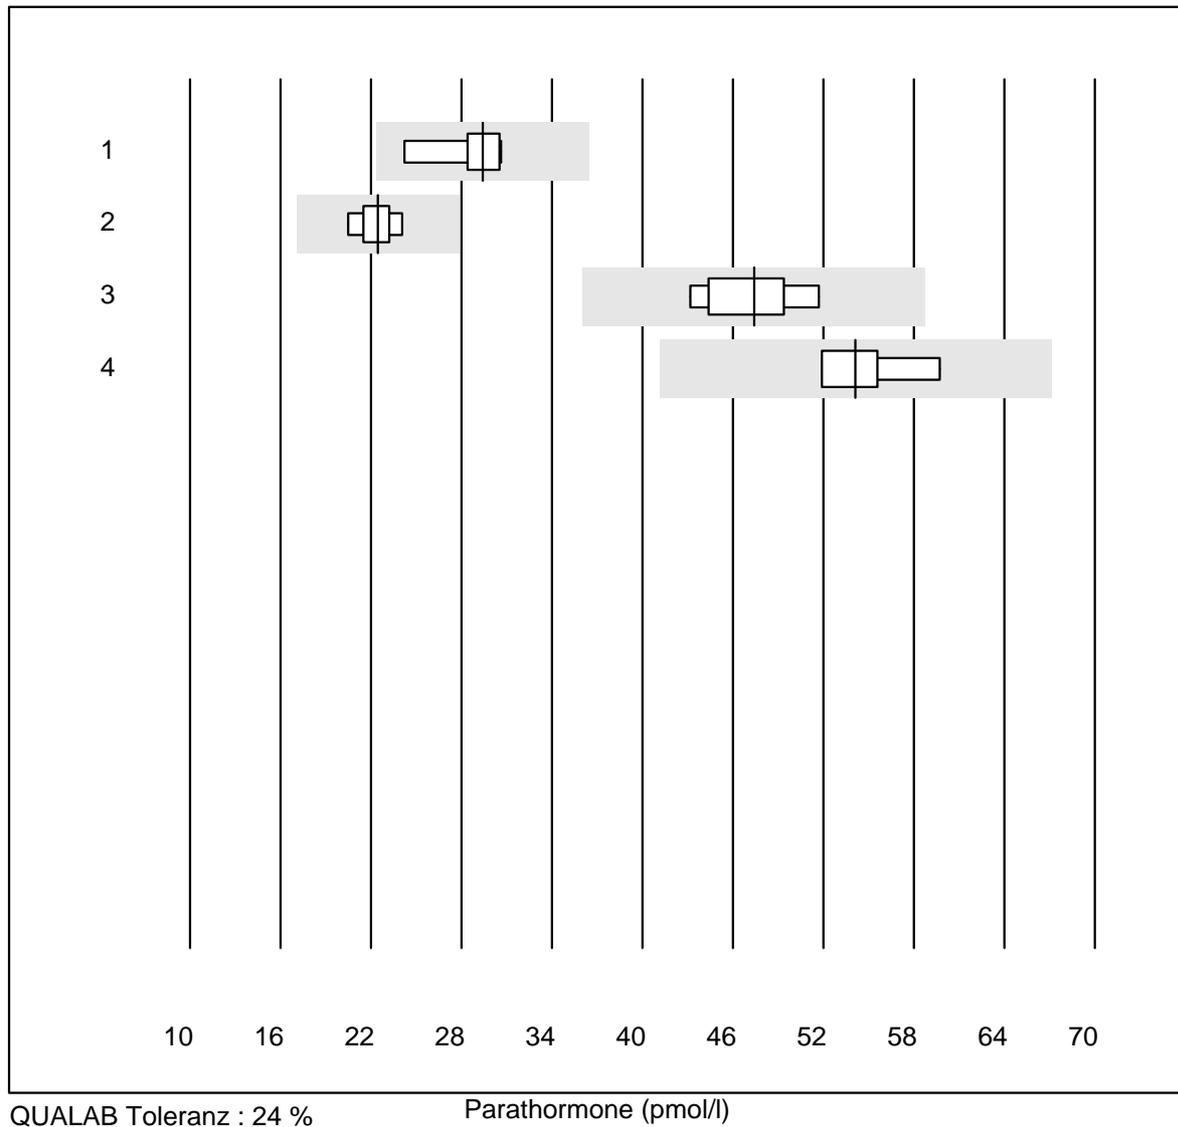


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas PTH STAT	5	100.0	0.0	0.0	29.4	9.2	e*
2	Cobas	5	100.0	0.0	0.0	22.5	6.2	e
3	Architect	5	100.0	0.0	0.0	47.4	7.4	e*
4	ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	54.1	6.4	e*

Osmolalité

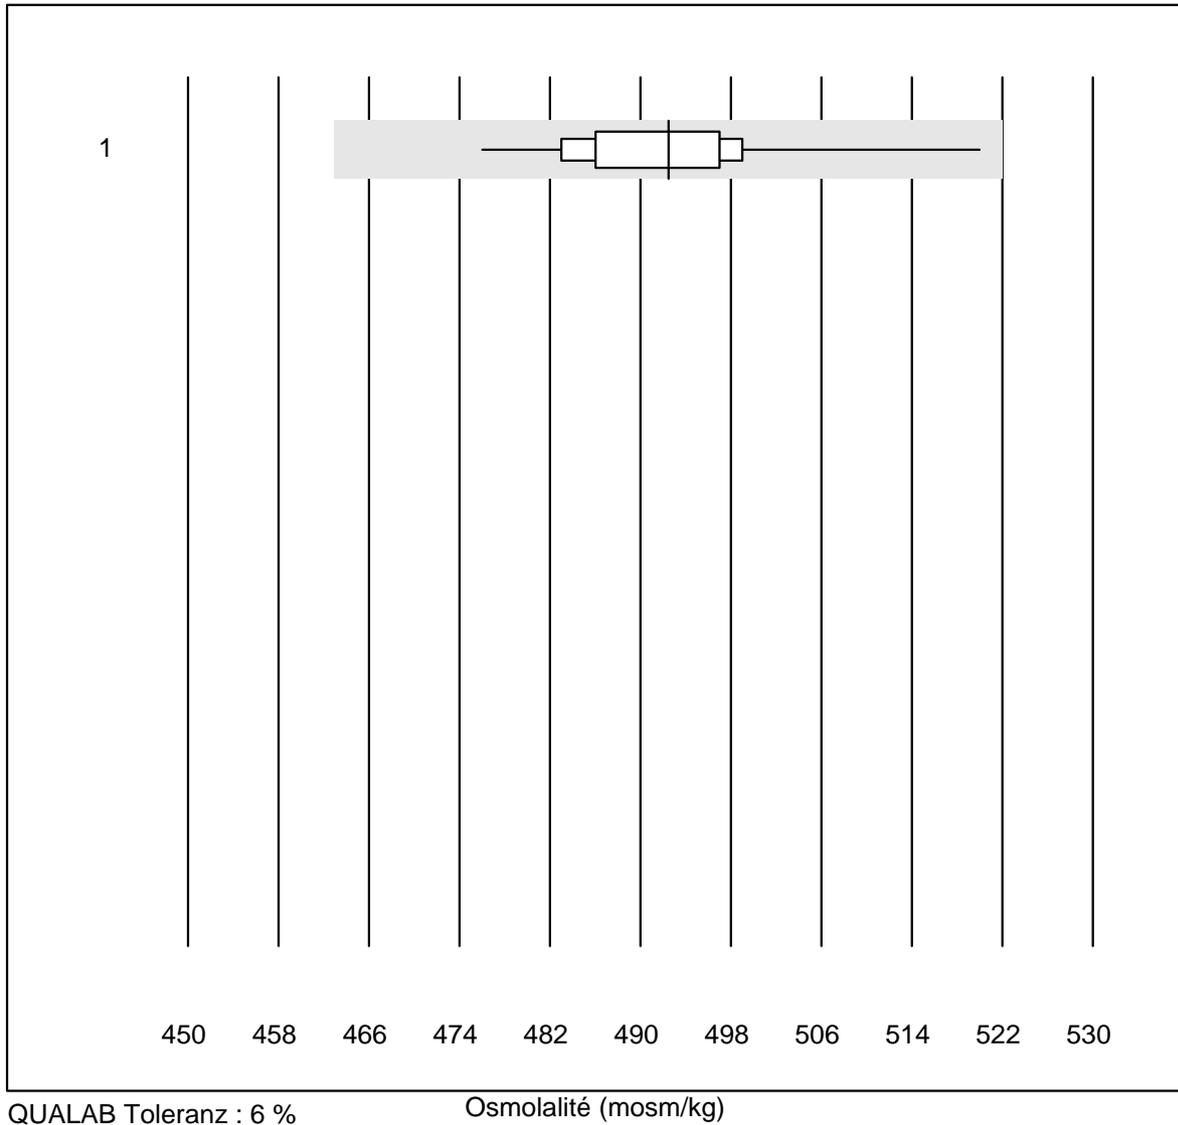

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cryoscopie	15	100.0	0.0	0.0	492	2.0	e

Kalium-K22

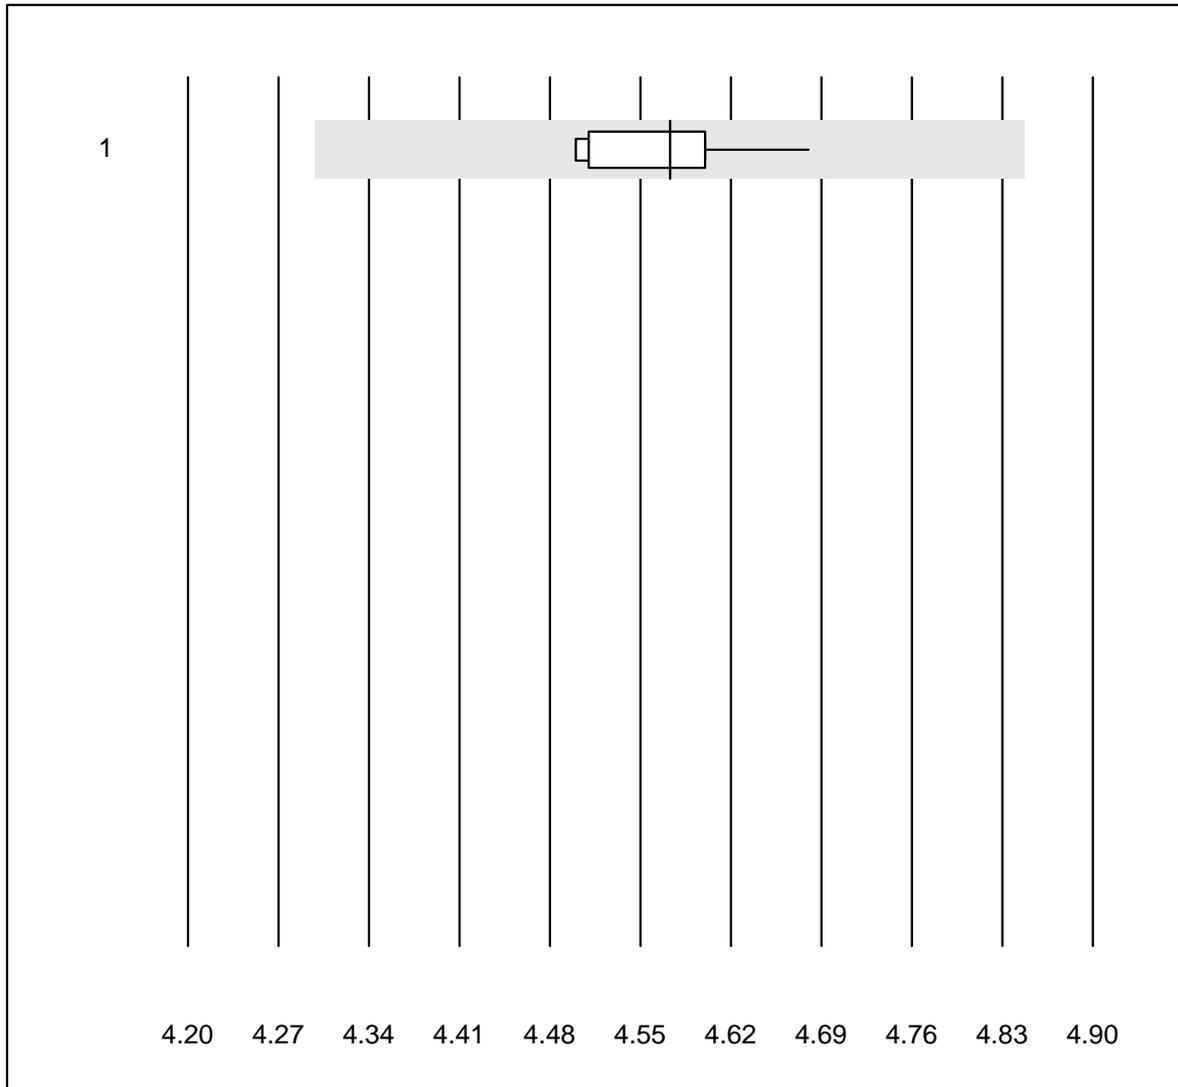


QUALAB Toleranz : 6 %

Kalium-K22 (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 ISE	11	100.0	0.0	0.0	4.6	1.2	e

Natrium-K22

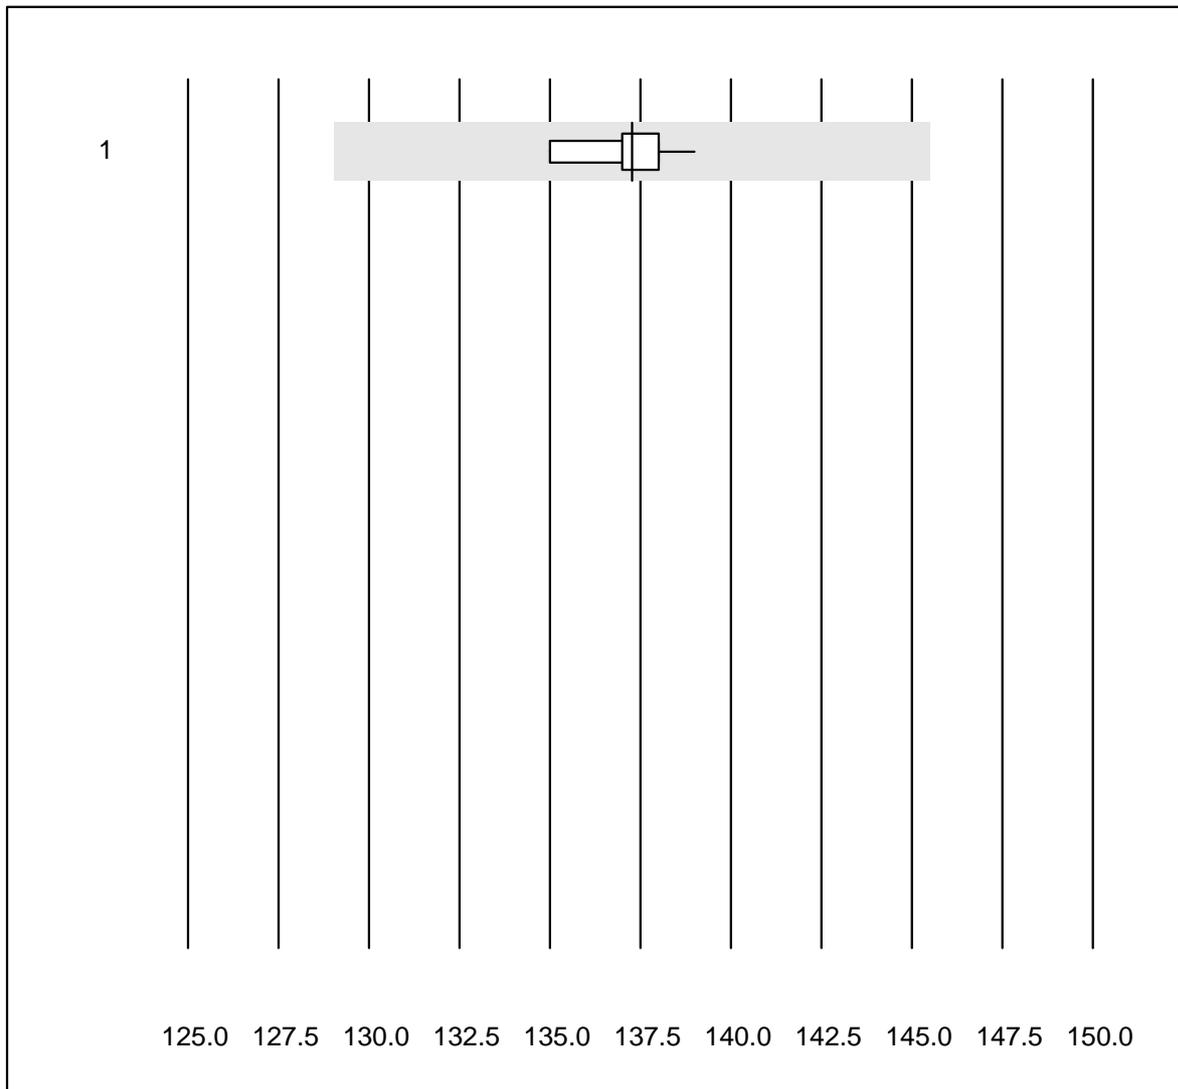


QUALAB Toleranz : 6 %

Natrium-K22 (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 ISE	11	100.0	0.0	0.0	137	0.9	e

Glukose-K22

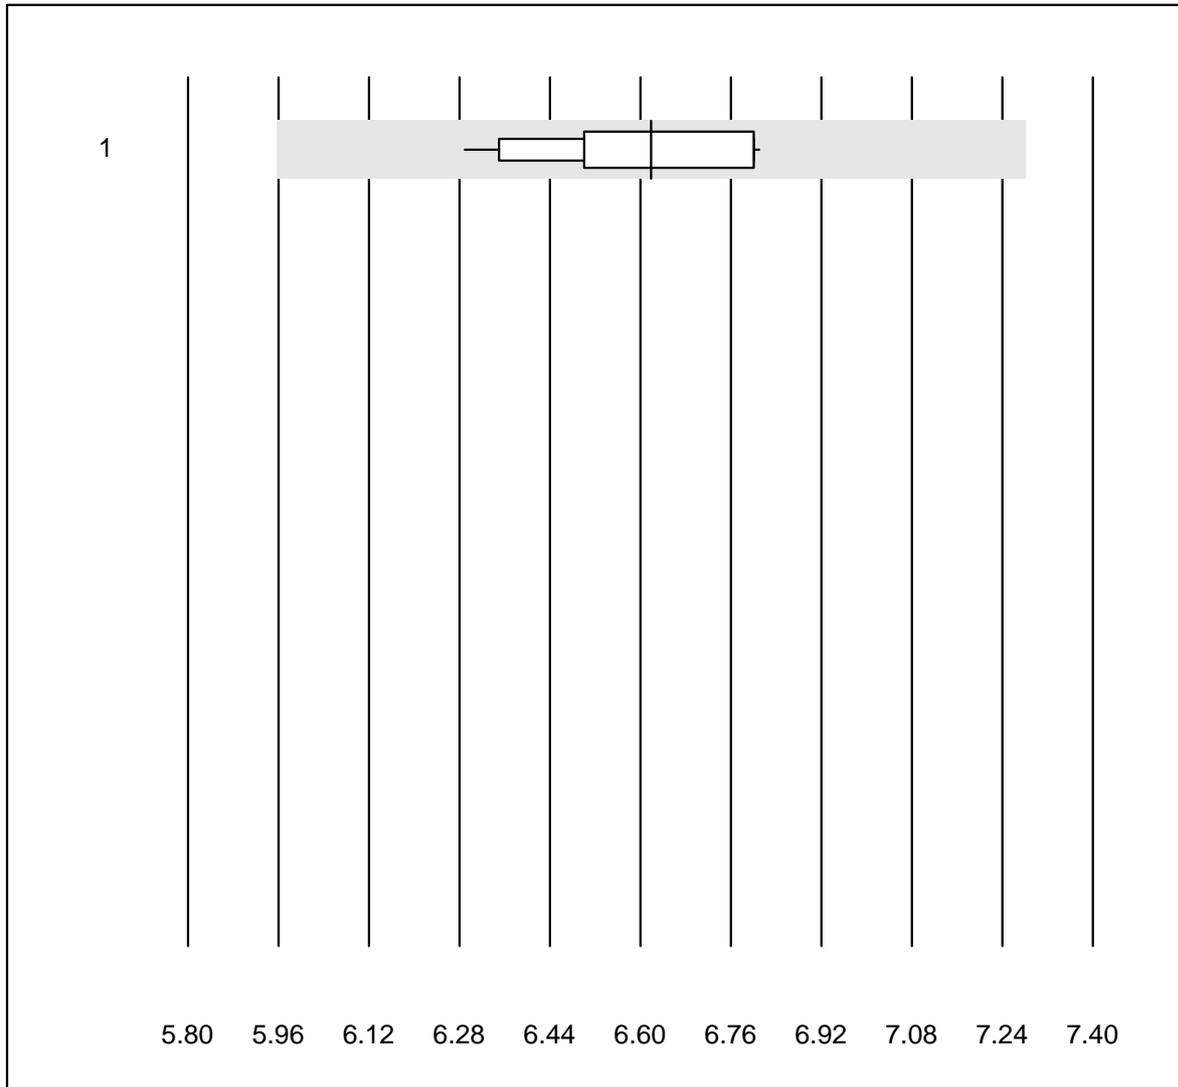


QUALAB Toleranz : 10 %

Glukose-K22 (mmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	11	100.0	0.0	0.0	6.6	2.8	e

Harnstoff-K22

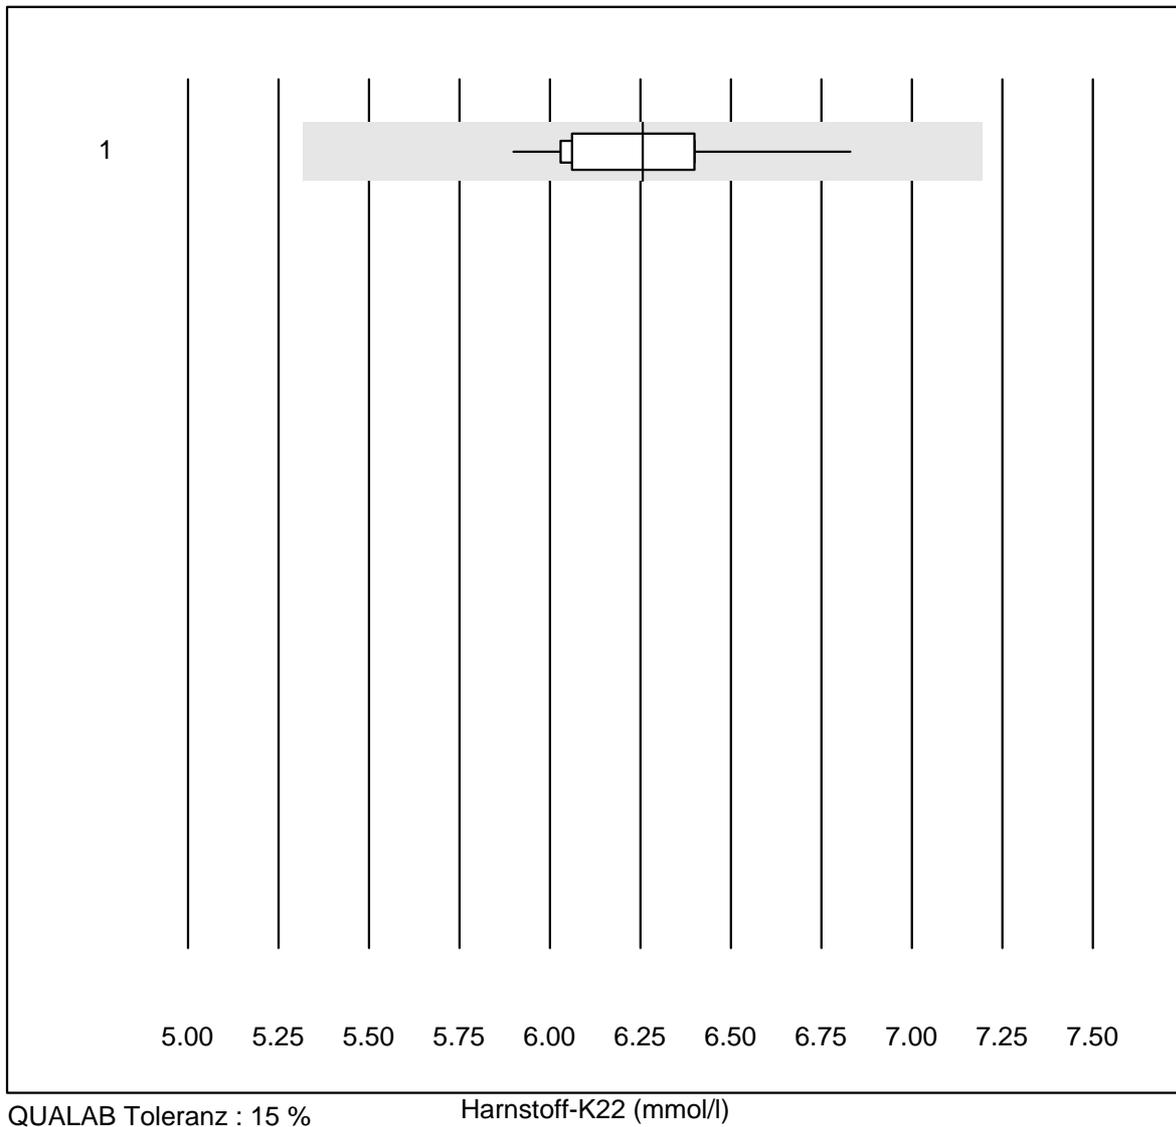


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	11	100.0	0.0	0.0	6.3	4.1	e

Osmotische Lücke

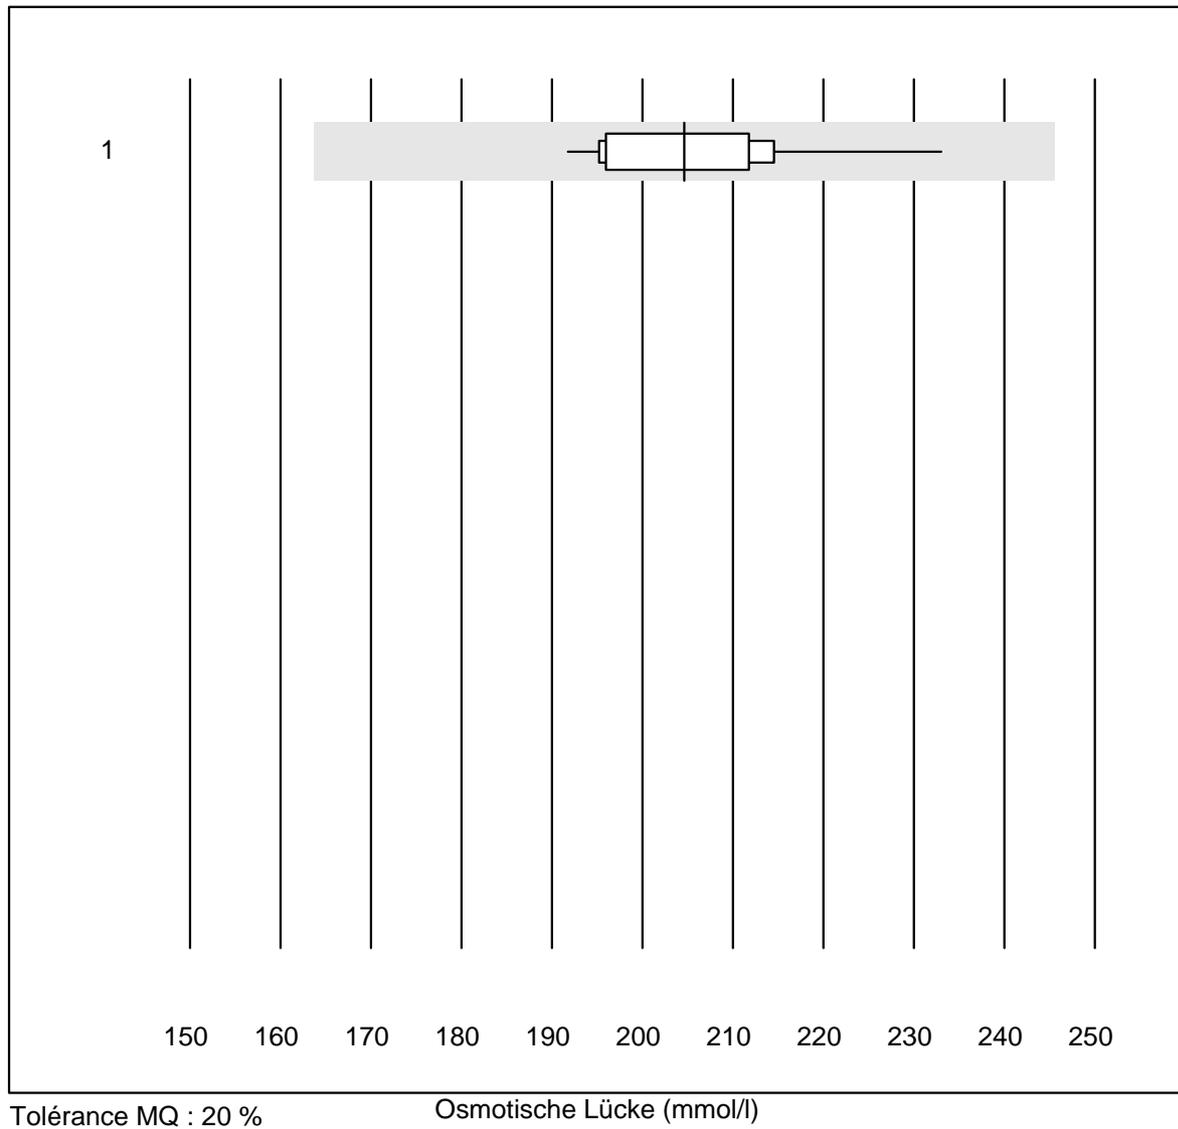


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Formel 1 (2Na+K+Glu+	11	100.0	0.0	0.0	204.6	5.7	e

Digoxin

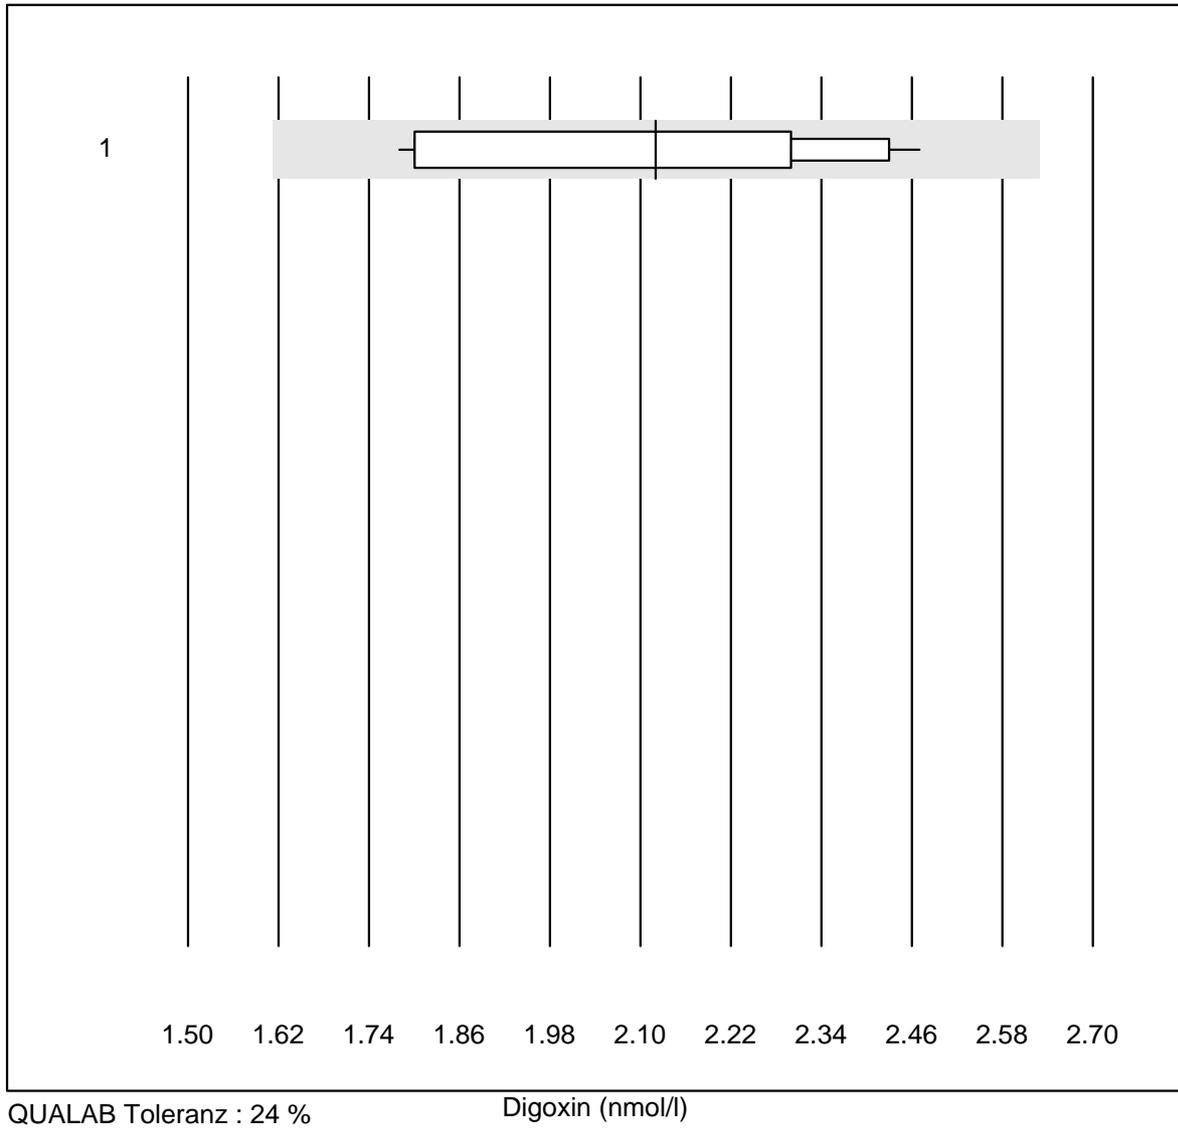

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Autres méthodes	12	100.0	0.0	0.0	2.12	12.6	e*

Phenobarbital

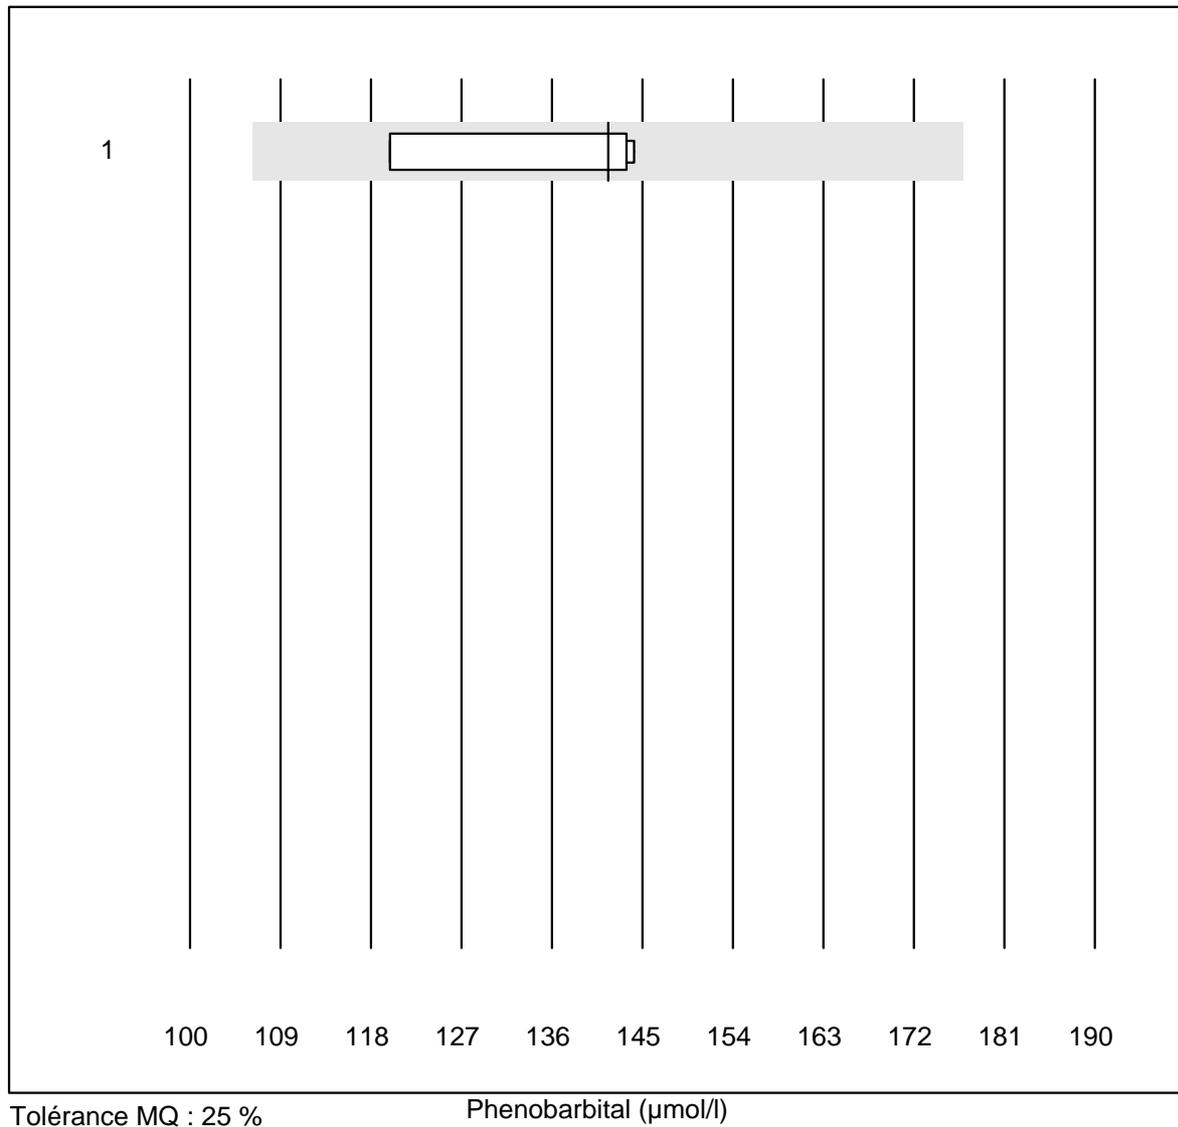

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	142	8.4	e*

Paracetamol




Tolérance MQ : 25 %

Paracetamol (µmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	298.0	6.1	a

Valproat

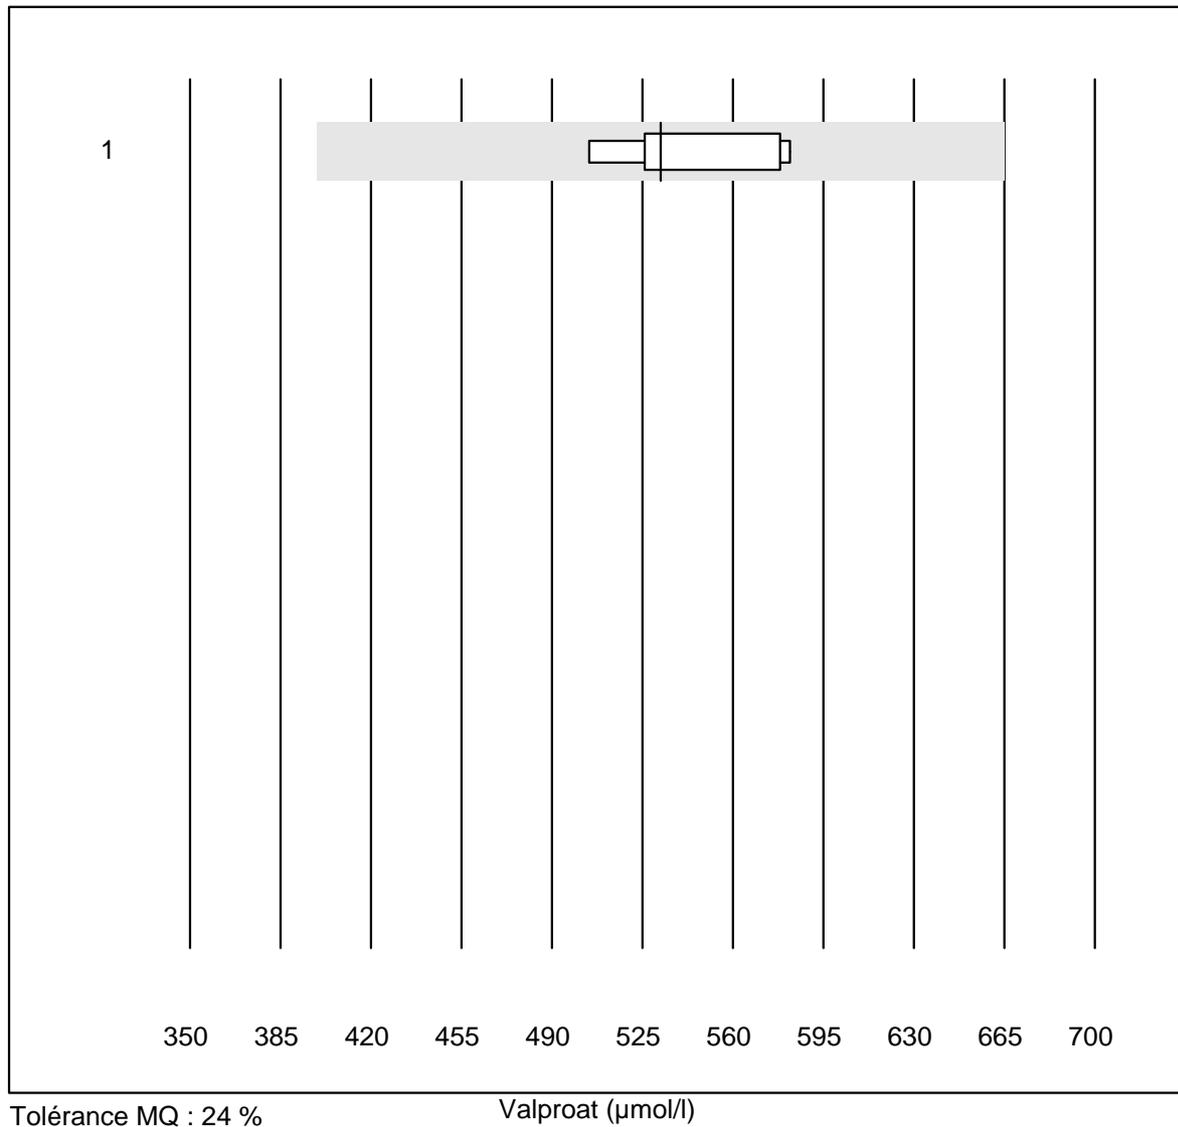

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	532.0	5.5	a

Cystatin C

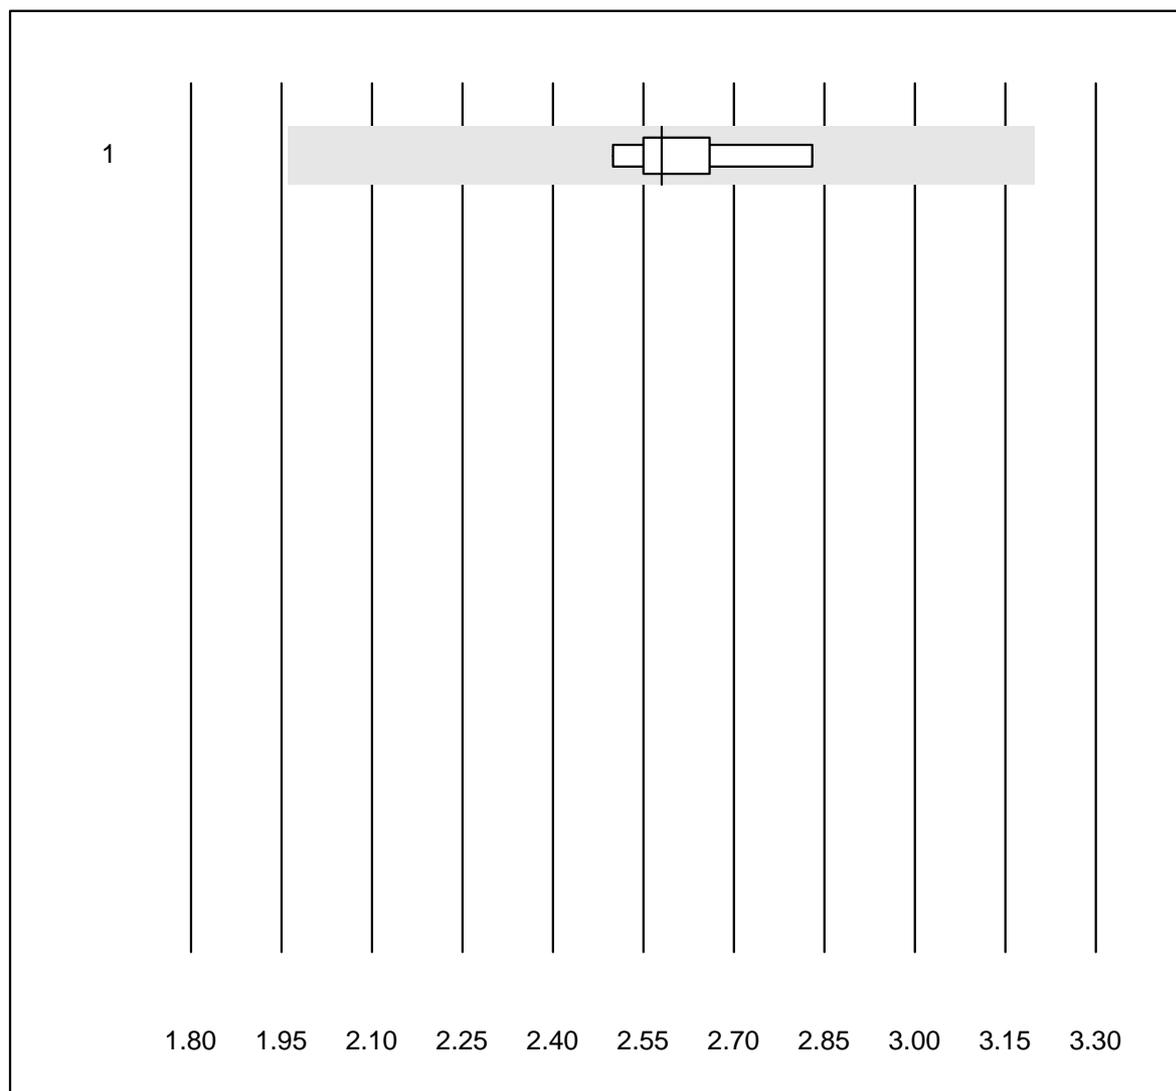


Tolérance MQ : 24 %

Cystatin C (mg/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	2.6	4.1	e

Éthanol

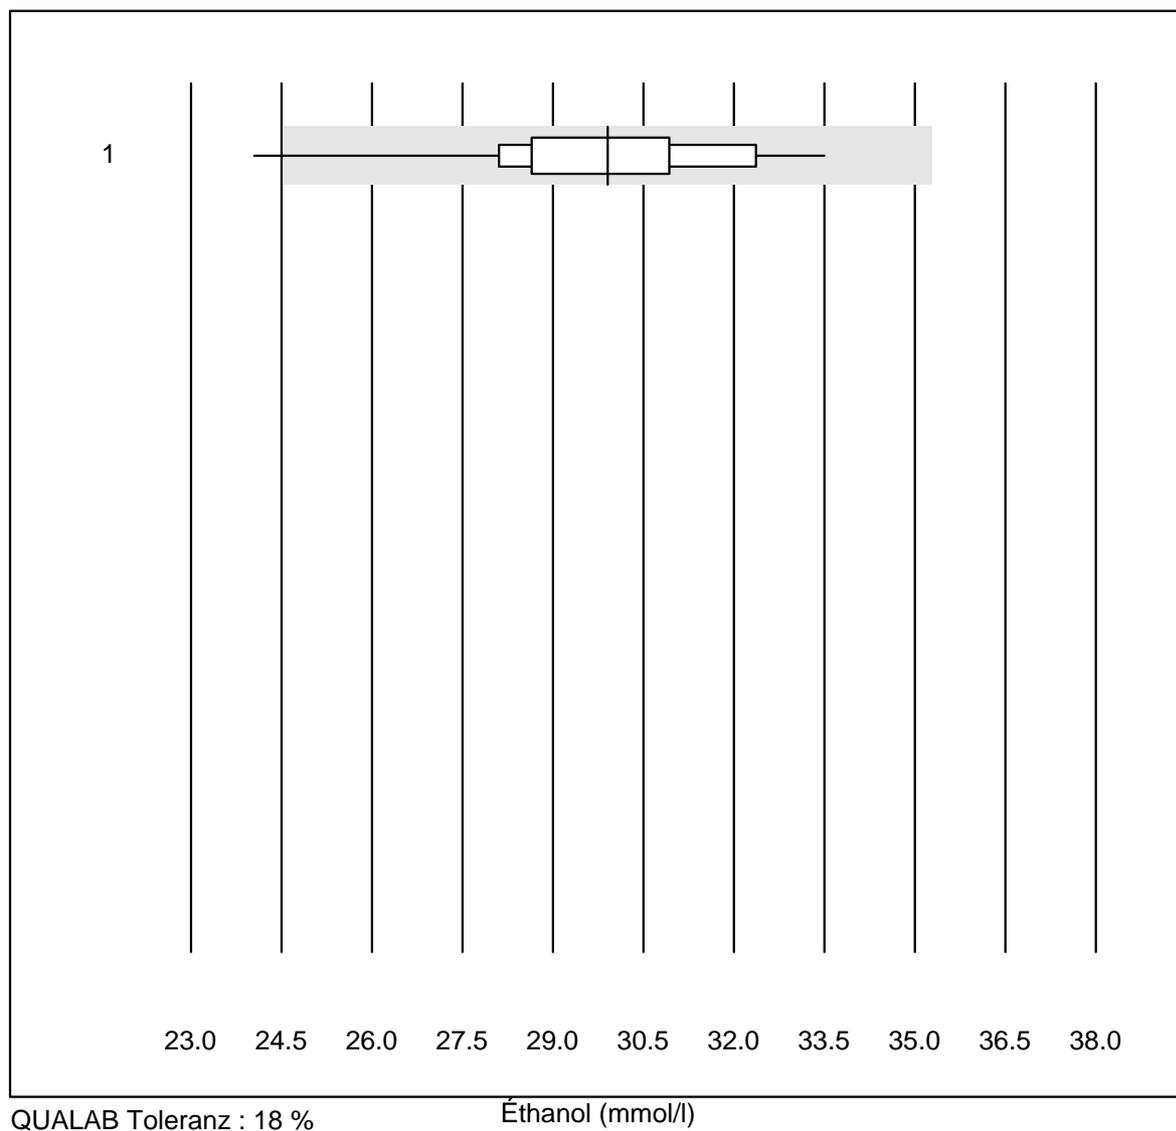


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	21	95.2	4.8	0.0	29.9	7.0	e

Calprotectin

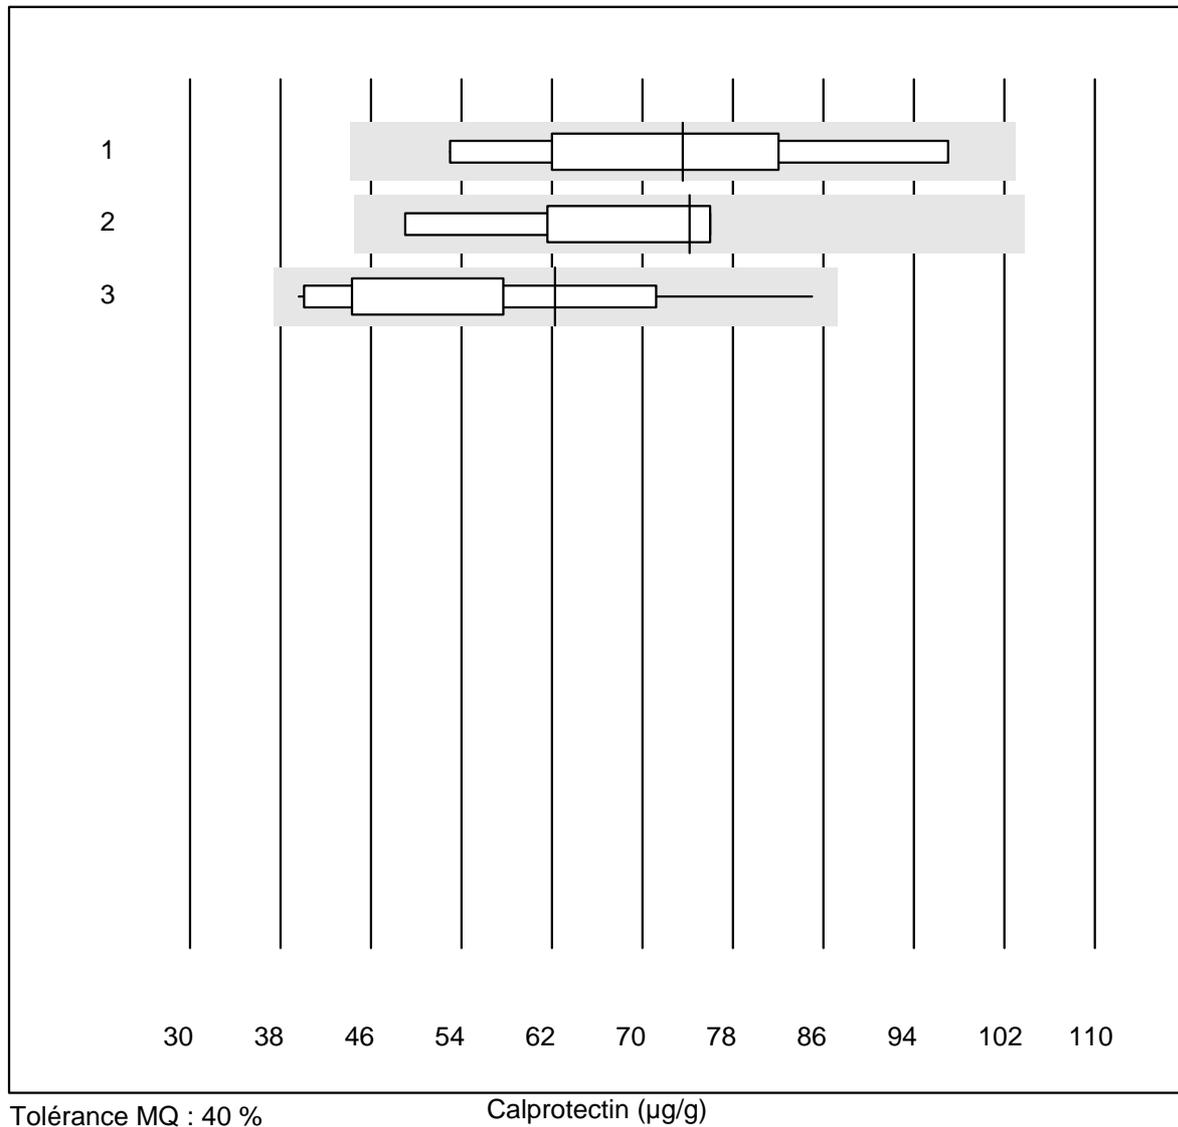


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Bühlmann ELISA	11	81.8	0.0	18.2	74	20.3	e*
2	Bühlmann fCALturbo	6	100.0	0.0	0.0	74	16.1	e*
3	Liaison	16	100.0	0.0	0.0	62	22.0	a

Cholestérol Af/b101

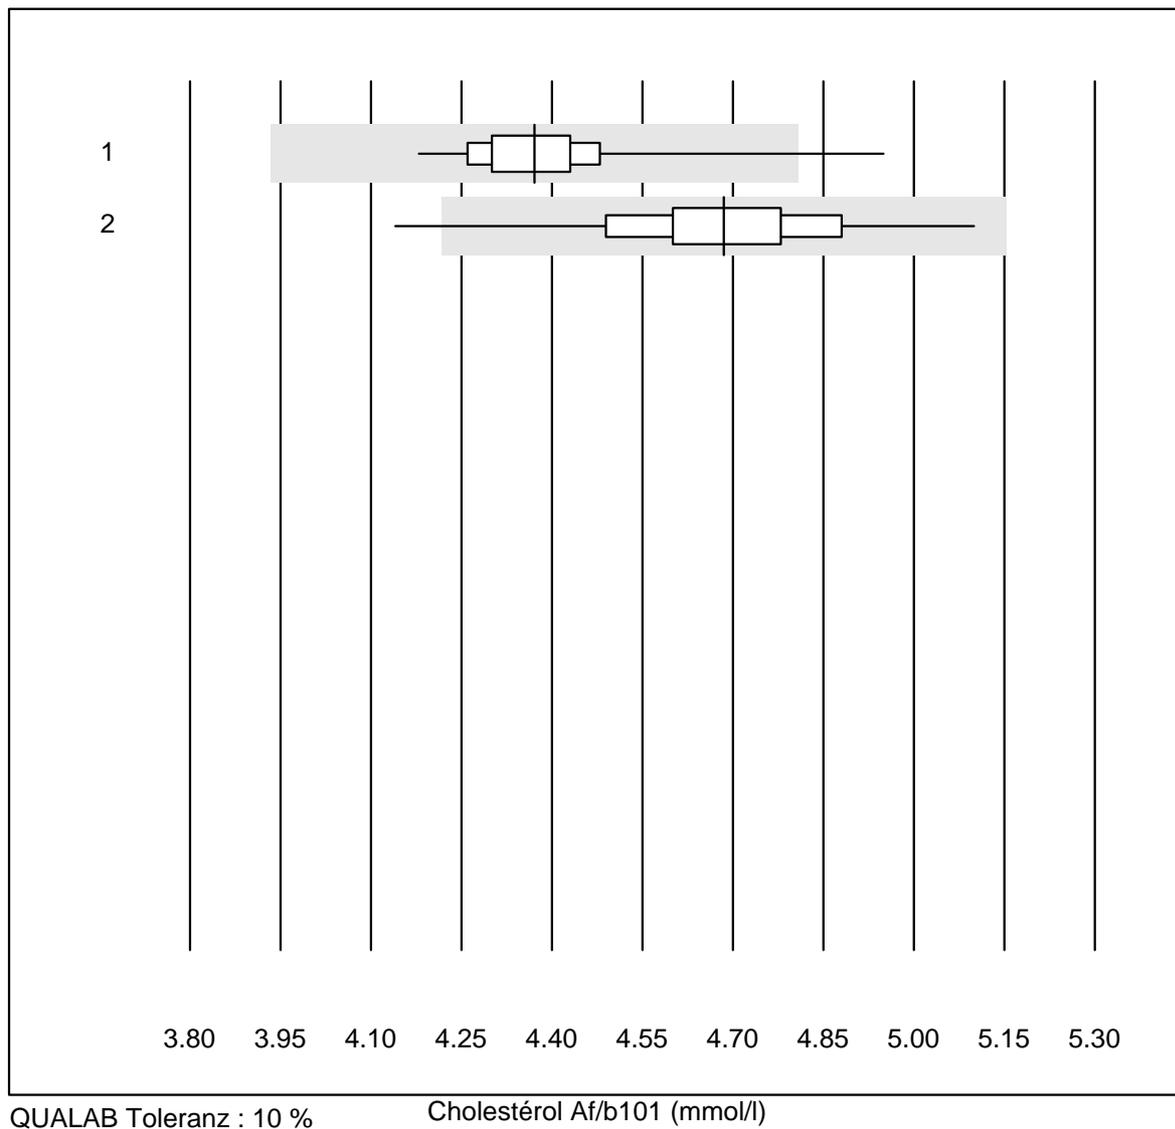


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas b101	138	99.3	0.7	0.0	4.37	2.4	e
2 Afinion	441	99.0	0.5	0.5	4.69	3.1	e

Cholestérol HDL Af/b101

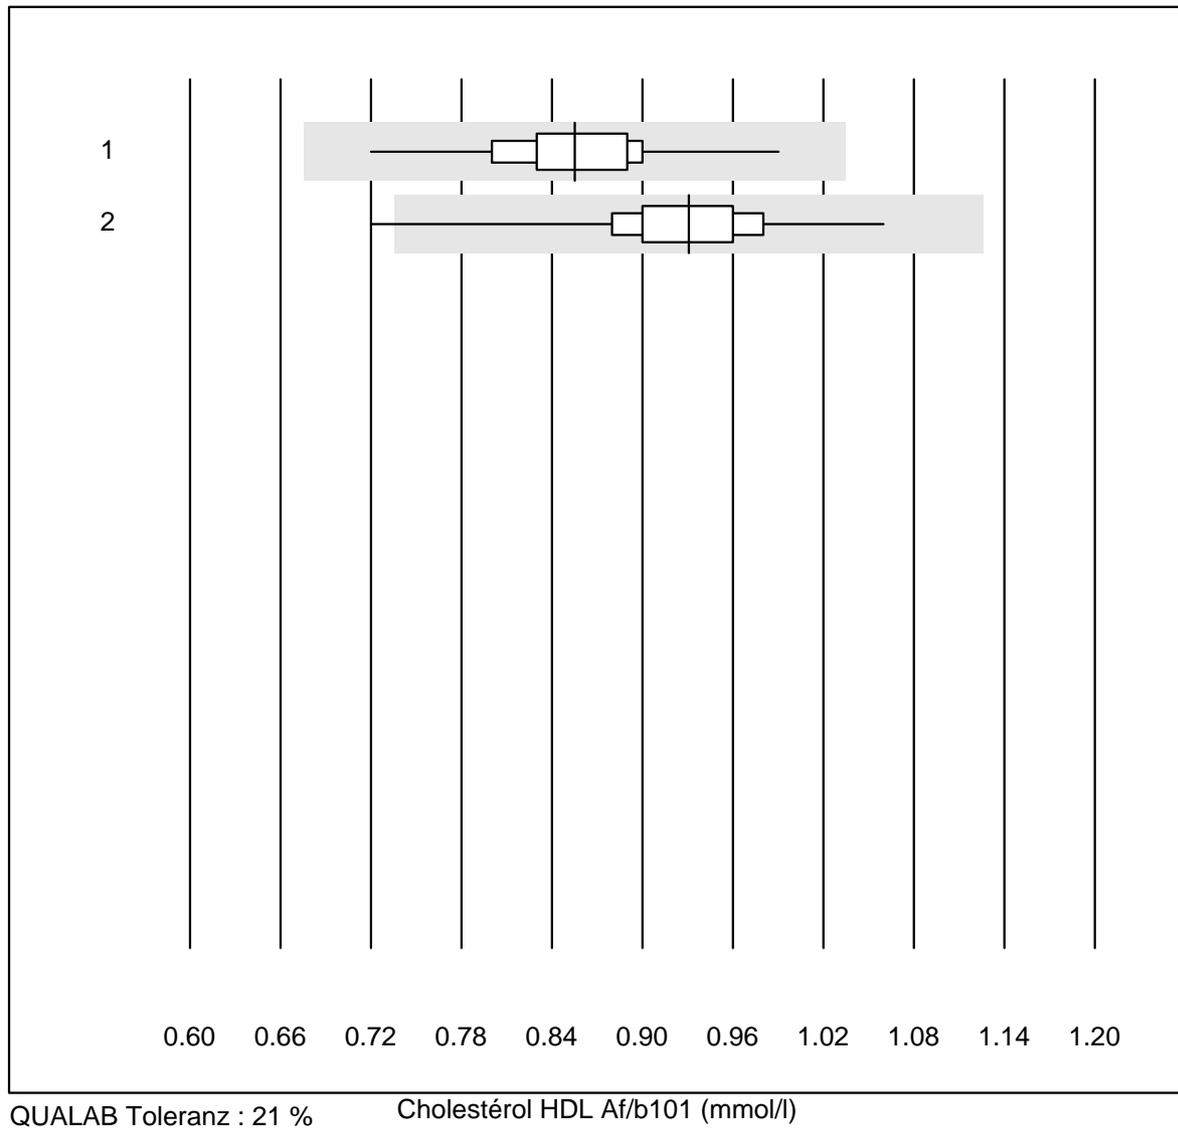


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas b101	138	94.2	0.0	5.8	0.86	5.3	e
2 Afinion	440	93.7	0.2	6.1	0.93	4.7	e

Triglycerides Af/b101

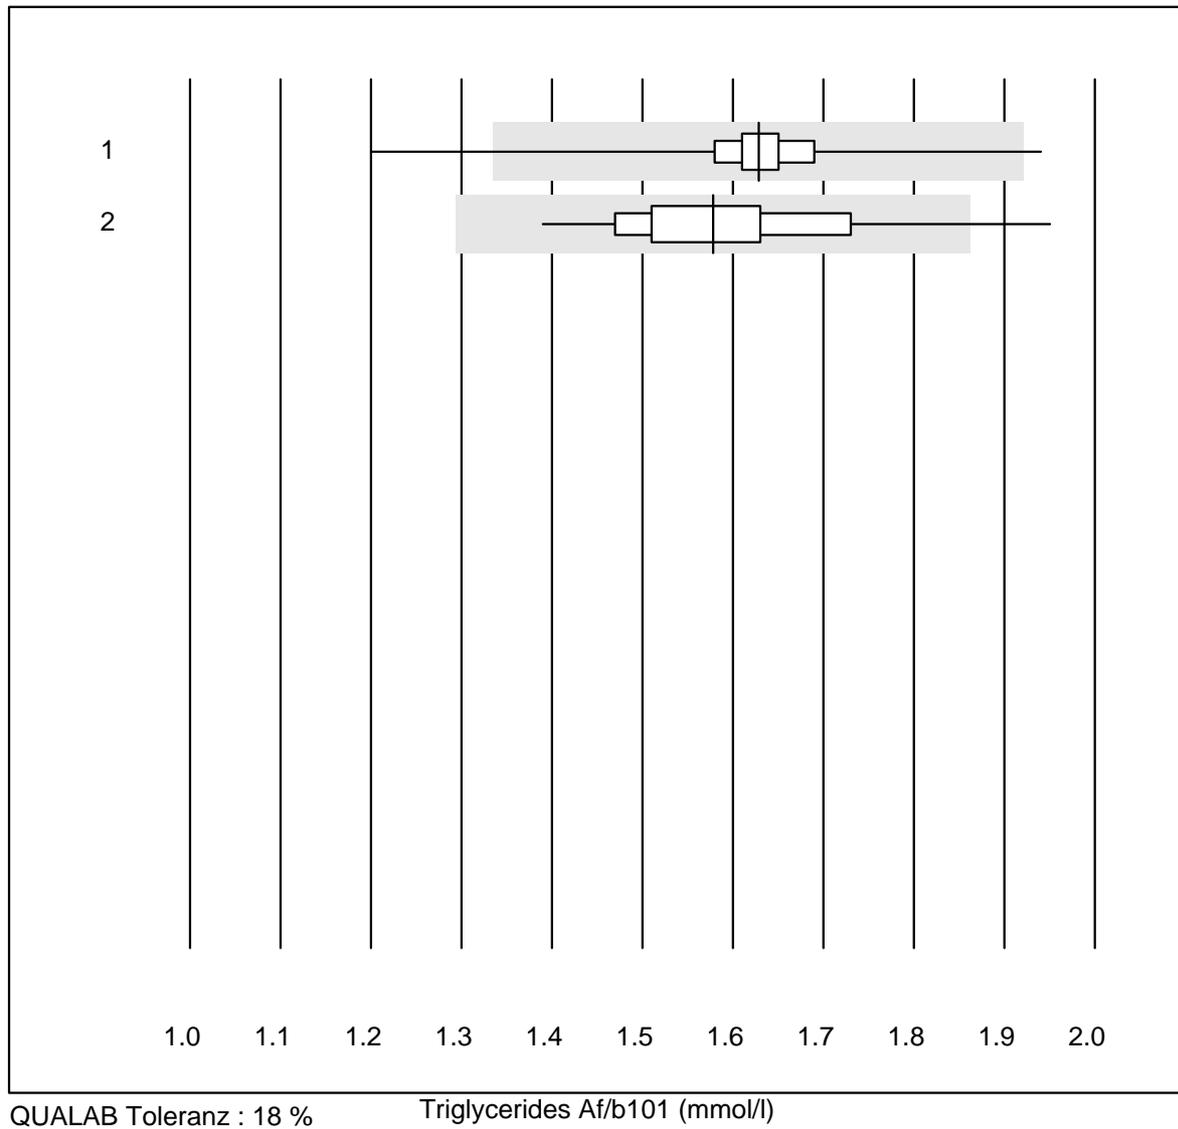

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas b101	135	98.5	1.5	0.0	1.63	3.7	e
2 Afinion	441	98.8	0.5	0.7	1.58	6.3	e

Troponine I S

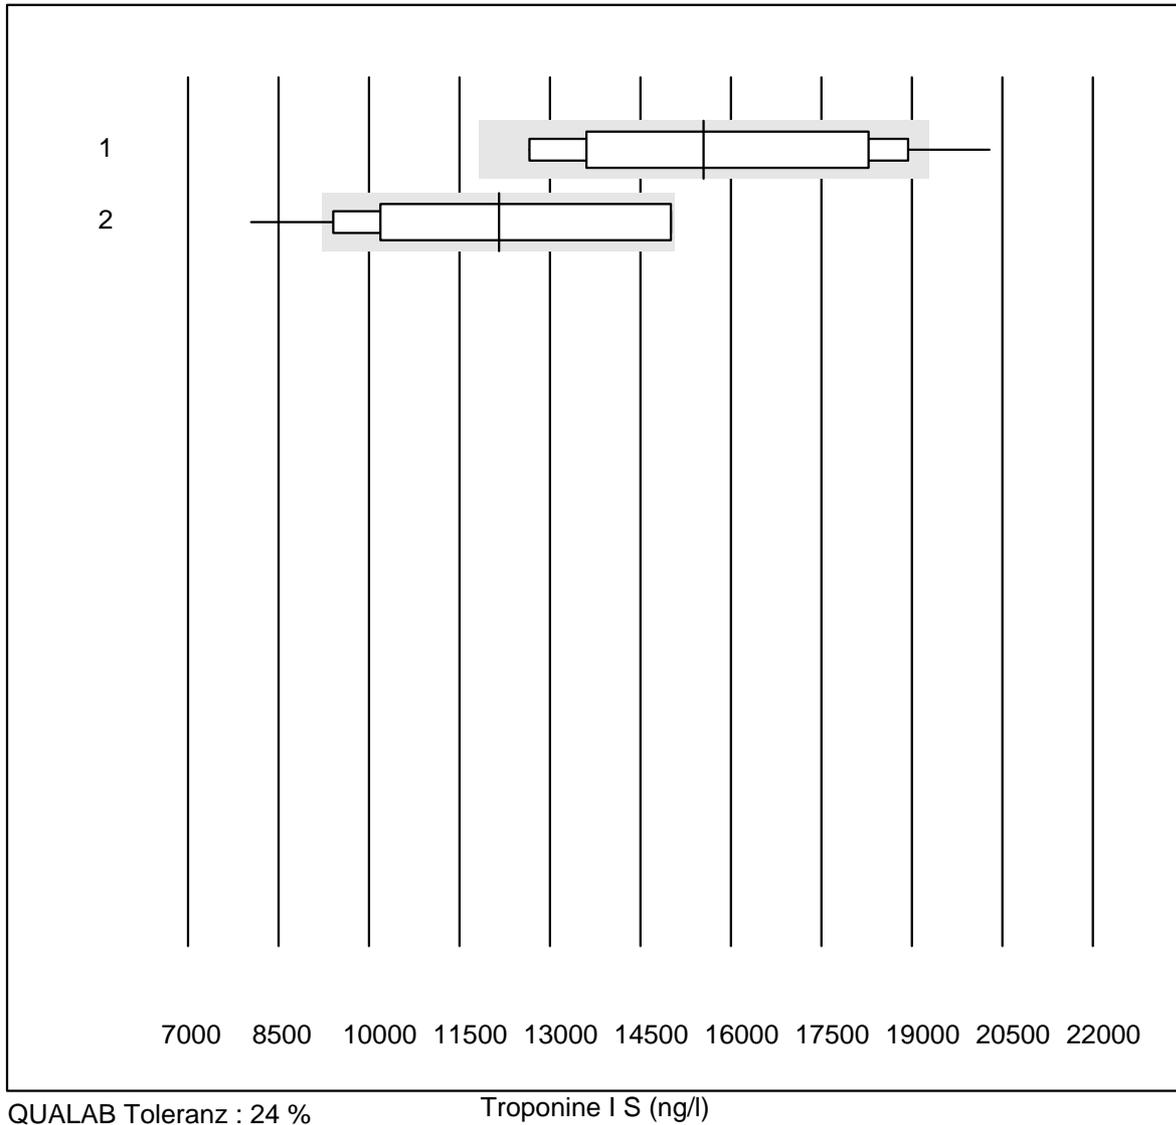


QUALAB Toleranz : 24 %

Troponine I S (ng/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Samsung LABGEO IB10	10	90.0	10.0	0.0	15550.00	15.8	e*
2	AFIAS	136	90.4	7.4	2.2	12150.00	18.3	a

D-Dimères qn S

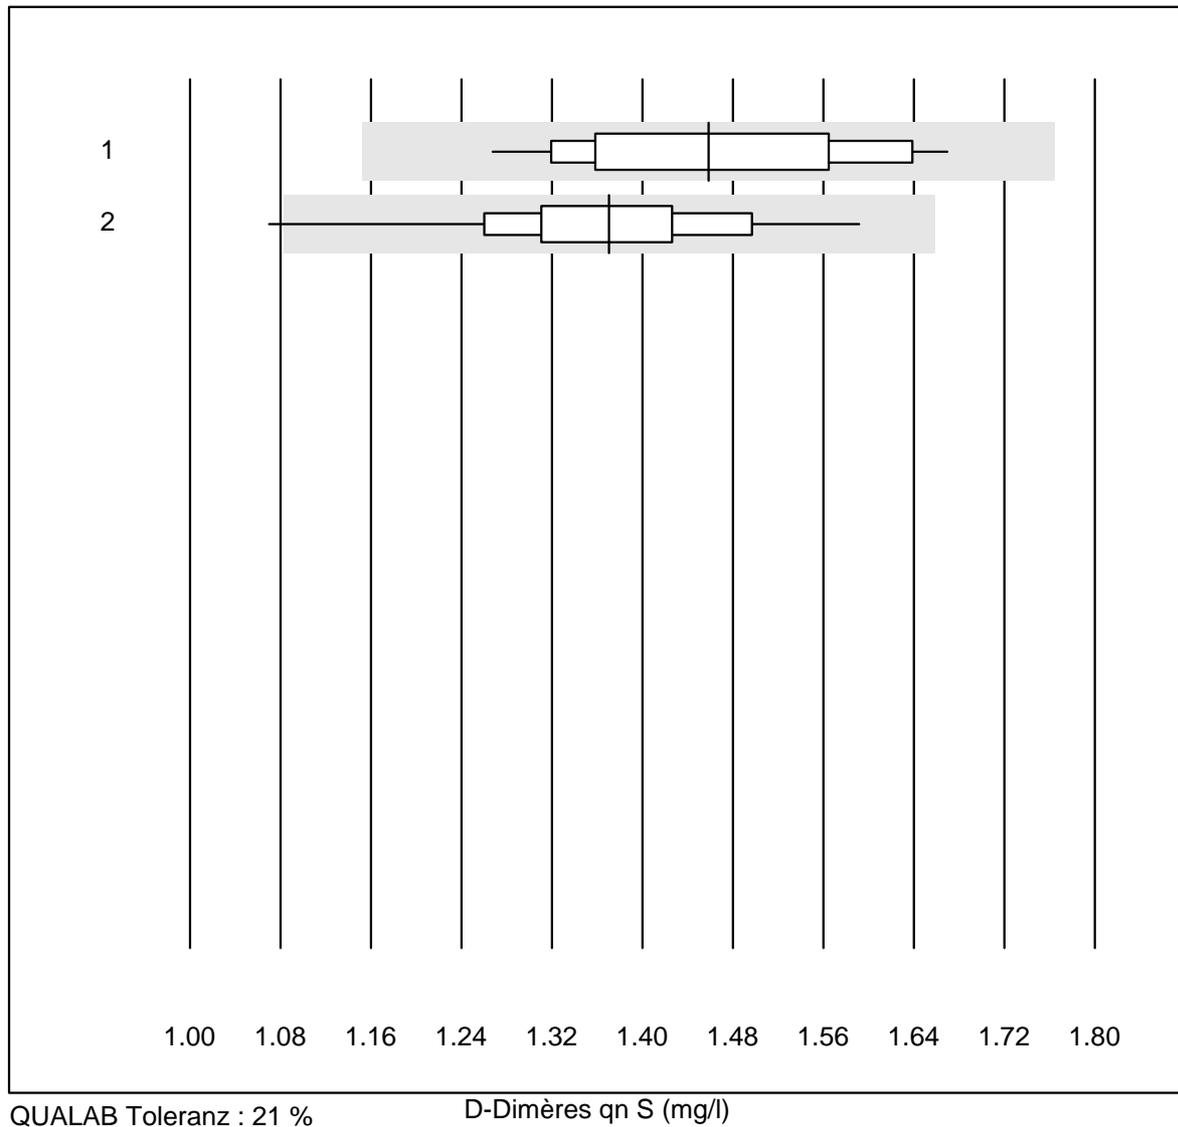


QUALAB Toleranz : 21 %

D-Dimères qn S (mg/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Samsung LABGEO IB10	15	80.0	0.0	20.0	1.46	8.9	e
2	AFIAS	141	88.0	0.7	11.3	1.37	6.6	e

NT-proBNP S

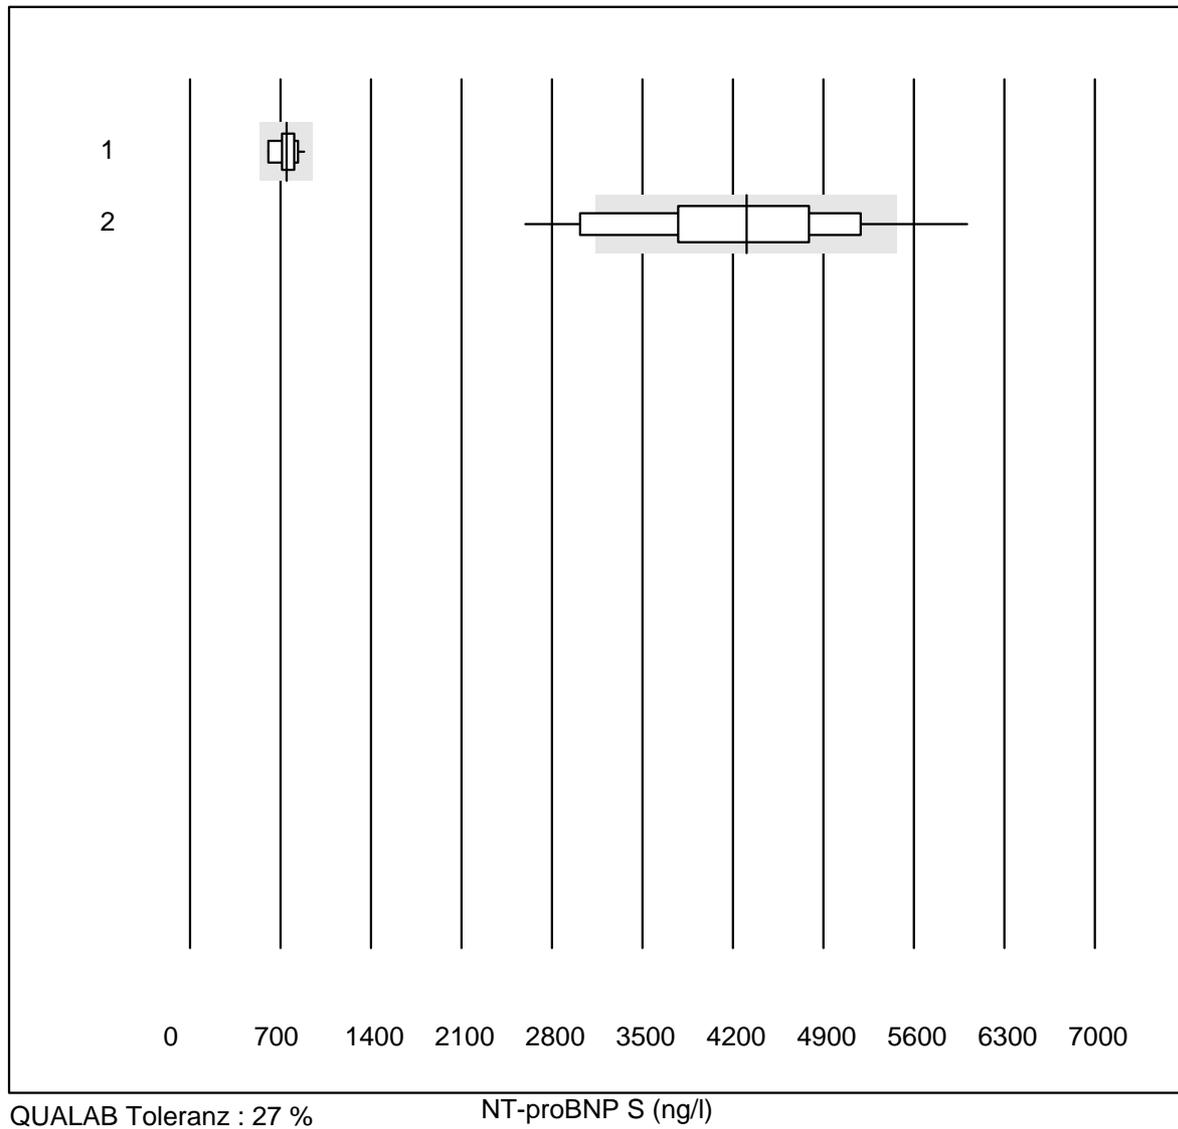


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Samsung LABGEO IB10	10	100.0	0.0	0.0	744.7	10.5	e*
2	AFIAS	108	68.5	14.8	16.7	4306.4	18.1	e

Homocystein

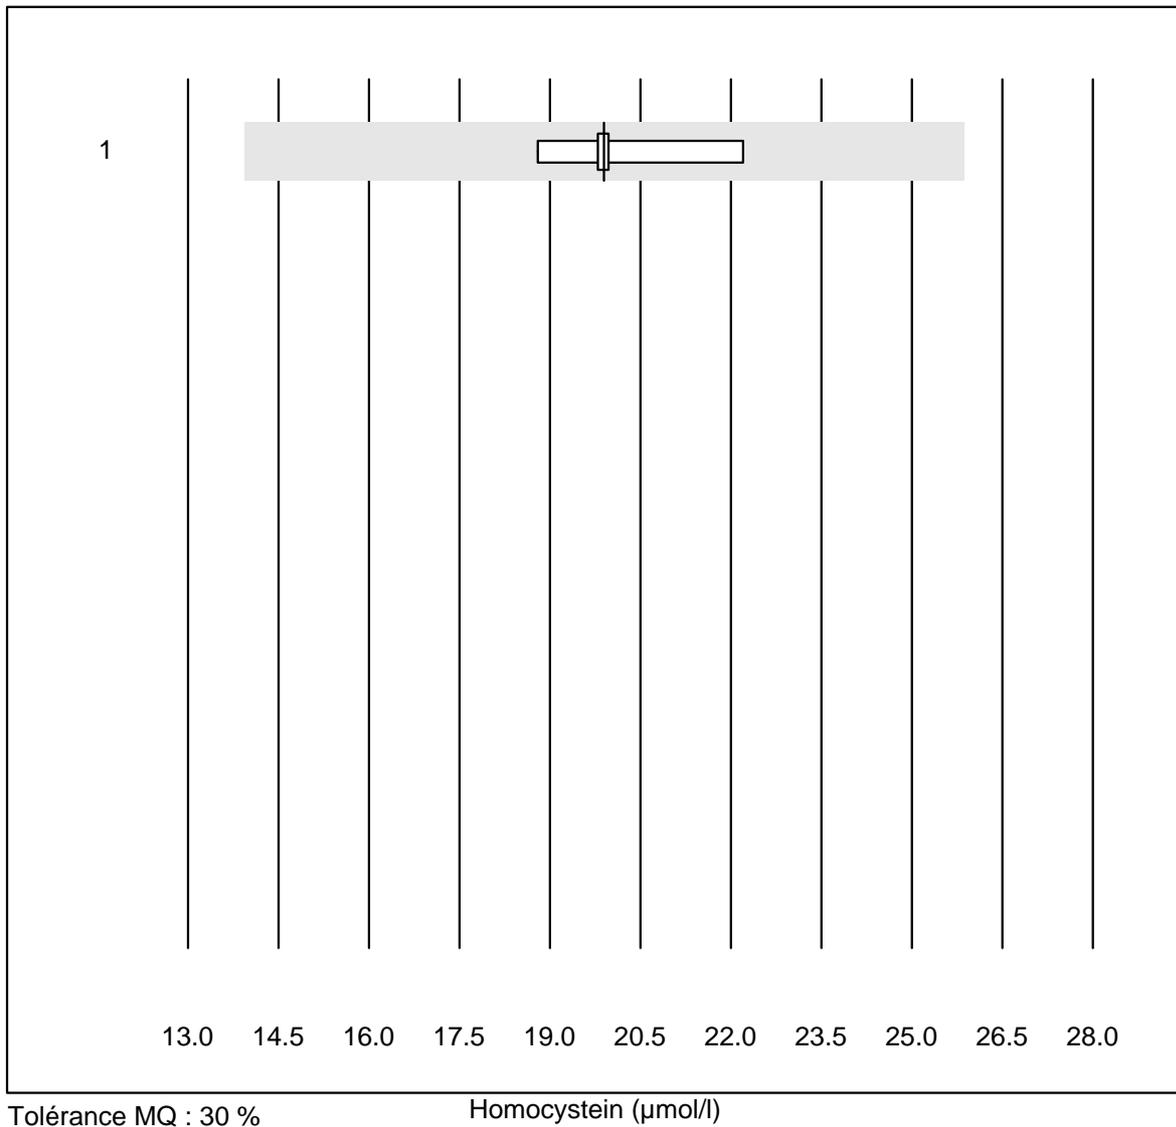

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	19.9	6.2	e

Lipase

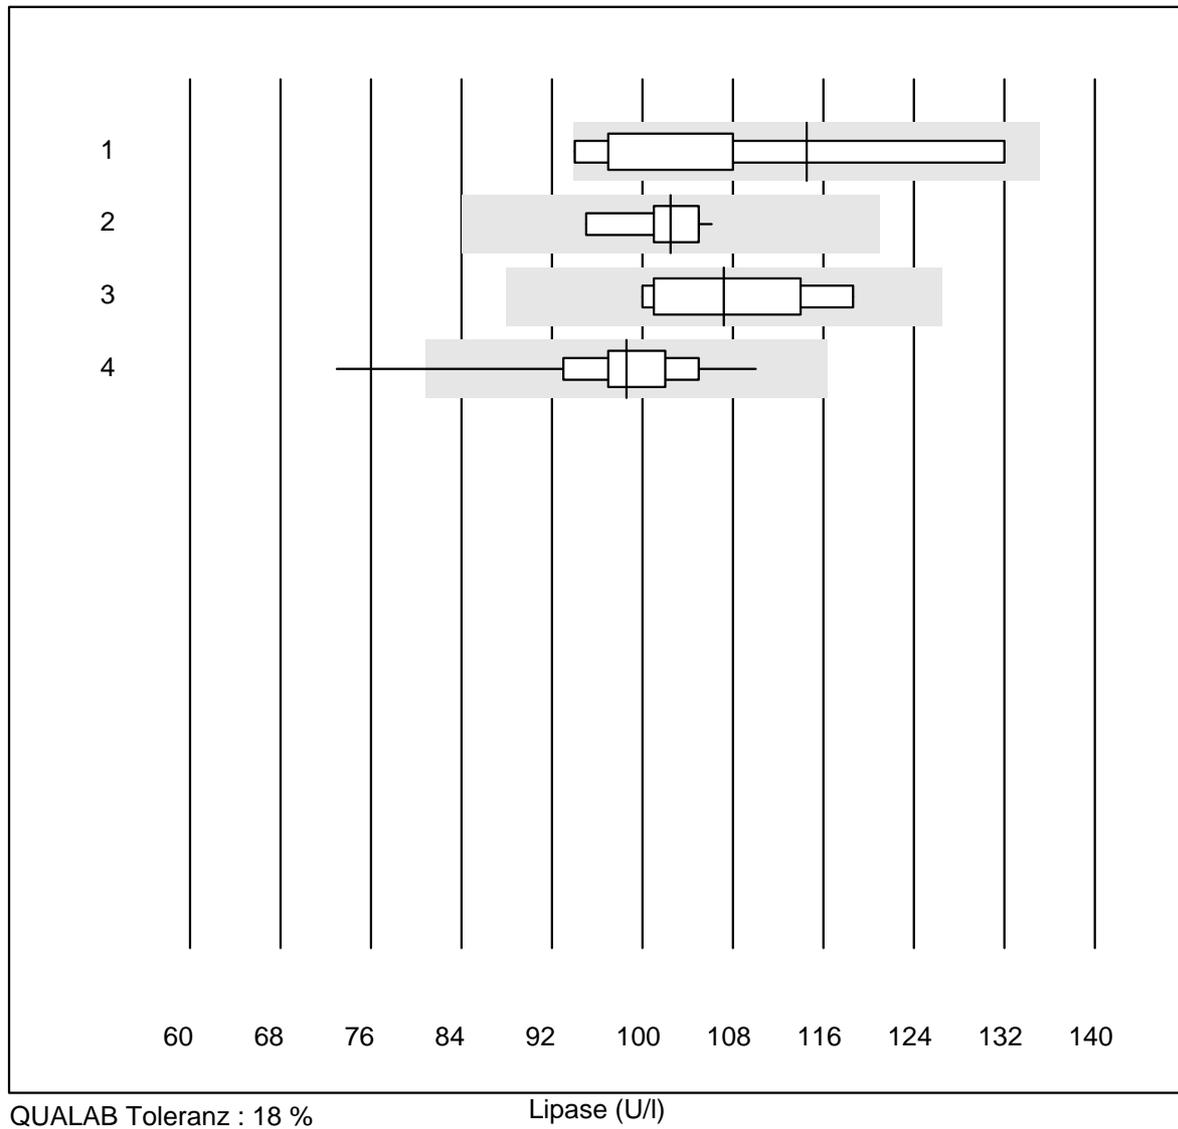


QUALAB Toleranz : 18 %

Lipase (U/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Architect	5	100.0	0.0	0.0	114.5	14.3	a
2	Beckman	10	100.0	0.0	0.0	102.5	3.2	e
3	Cobas	8	100.0	0.0	0.0	107.2	6.5	a
4	Fuji Dri-Chem	141	95.8	2.1	2.1	98.6	5.7	e

Cholinestérase

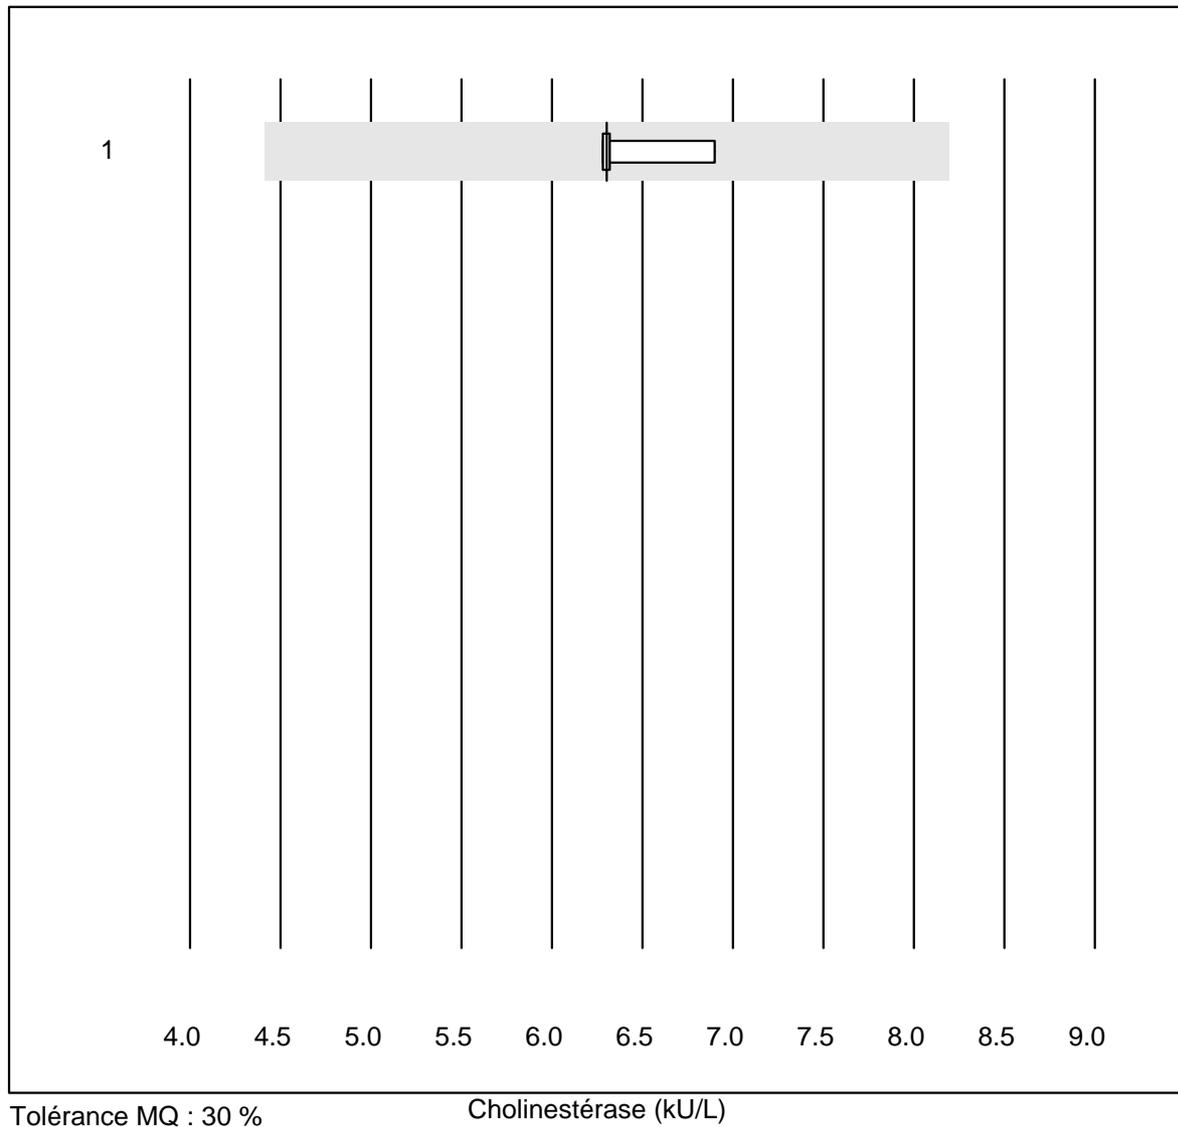

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	6.3	4.7	e

Glucose CSF

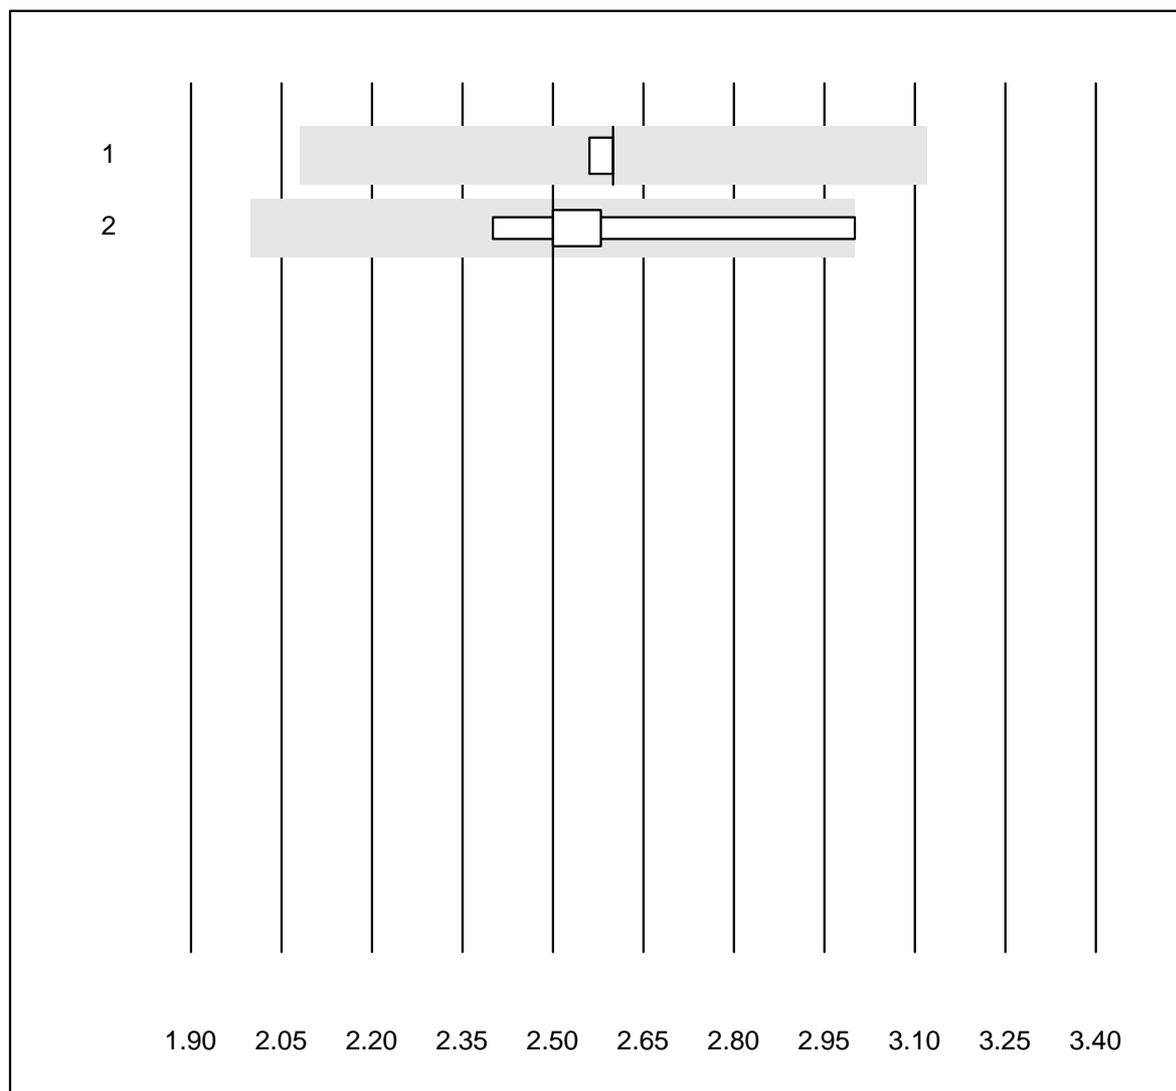


Tolérance MQ : 20 %

Glucose CSF (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	2.60	0.8	e
2 Autres méthodes	9	88.9	11.1	0.0	2.50	7.0	e

Lactate CSF

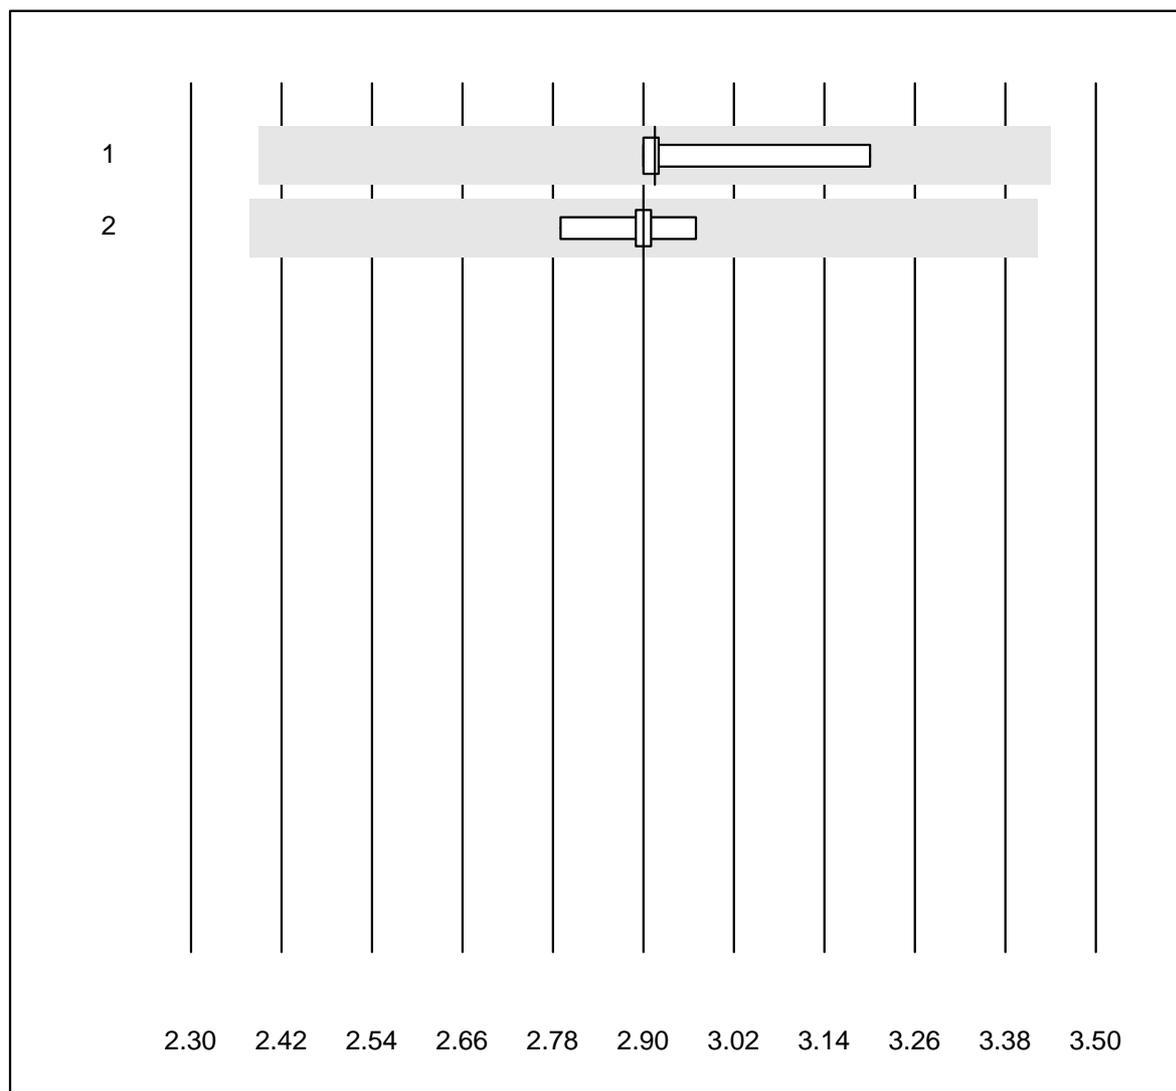


QUALAB Toleranz : 18 %

Lactate CSF (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	2.92	4.9	e*
2 Autres méthodes	7	100.0	0.0	0.0	2.90	1.8	e

Protéine CSF

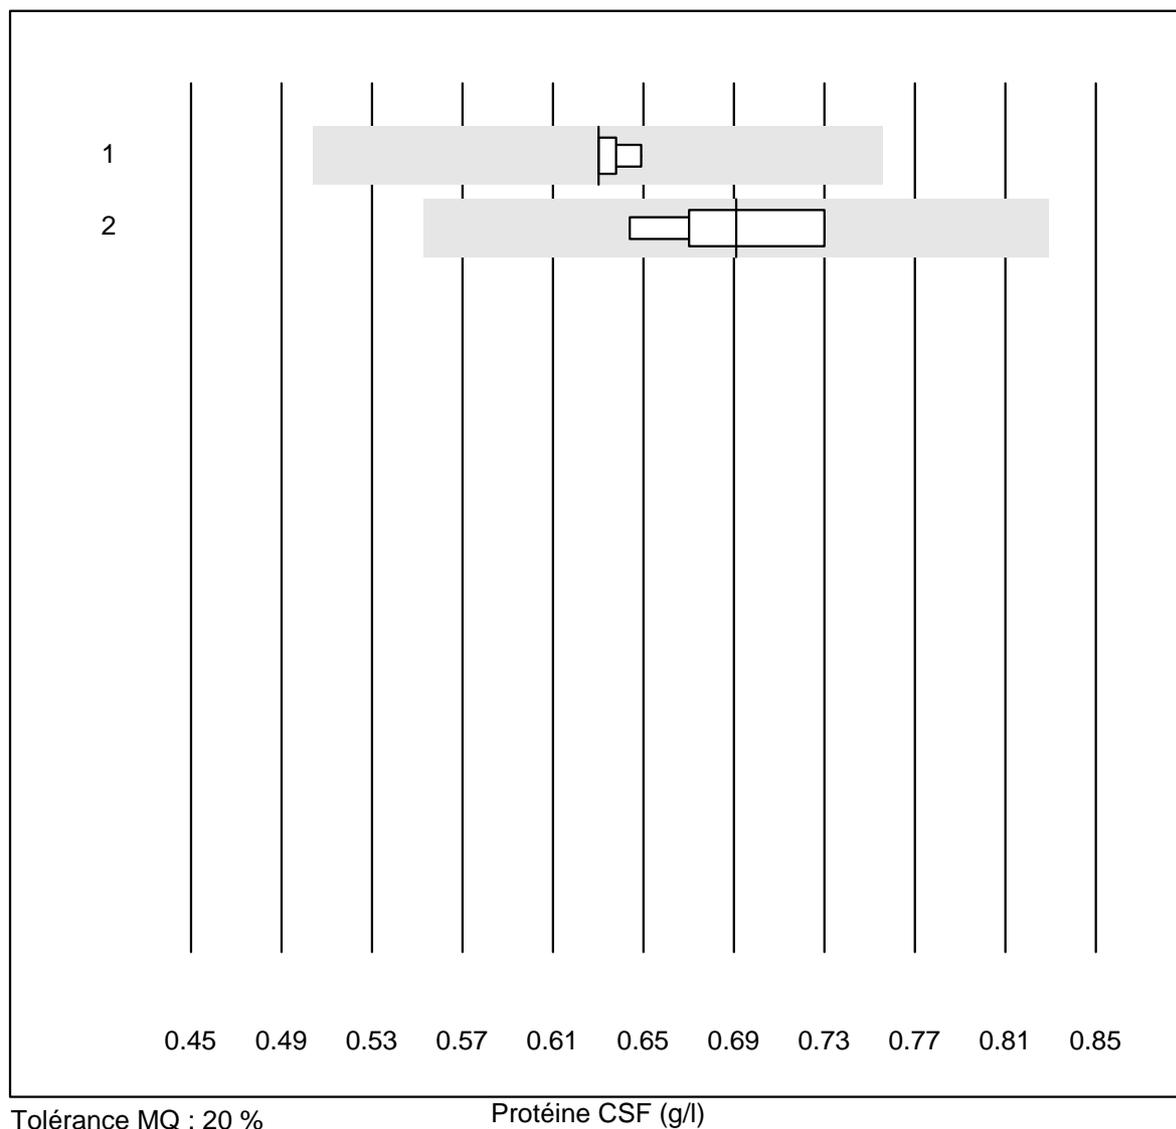


Tolérance MQ : 20 %

Protéine CSF (g/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	0.63	1.3	e
2 Autres méthodes	6	100.0	0.0	0.0	0.69	4.9	e

Albumine CSF

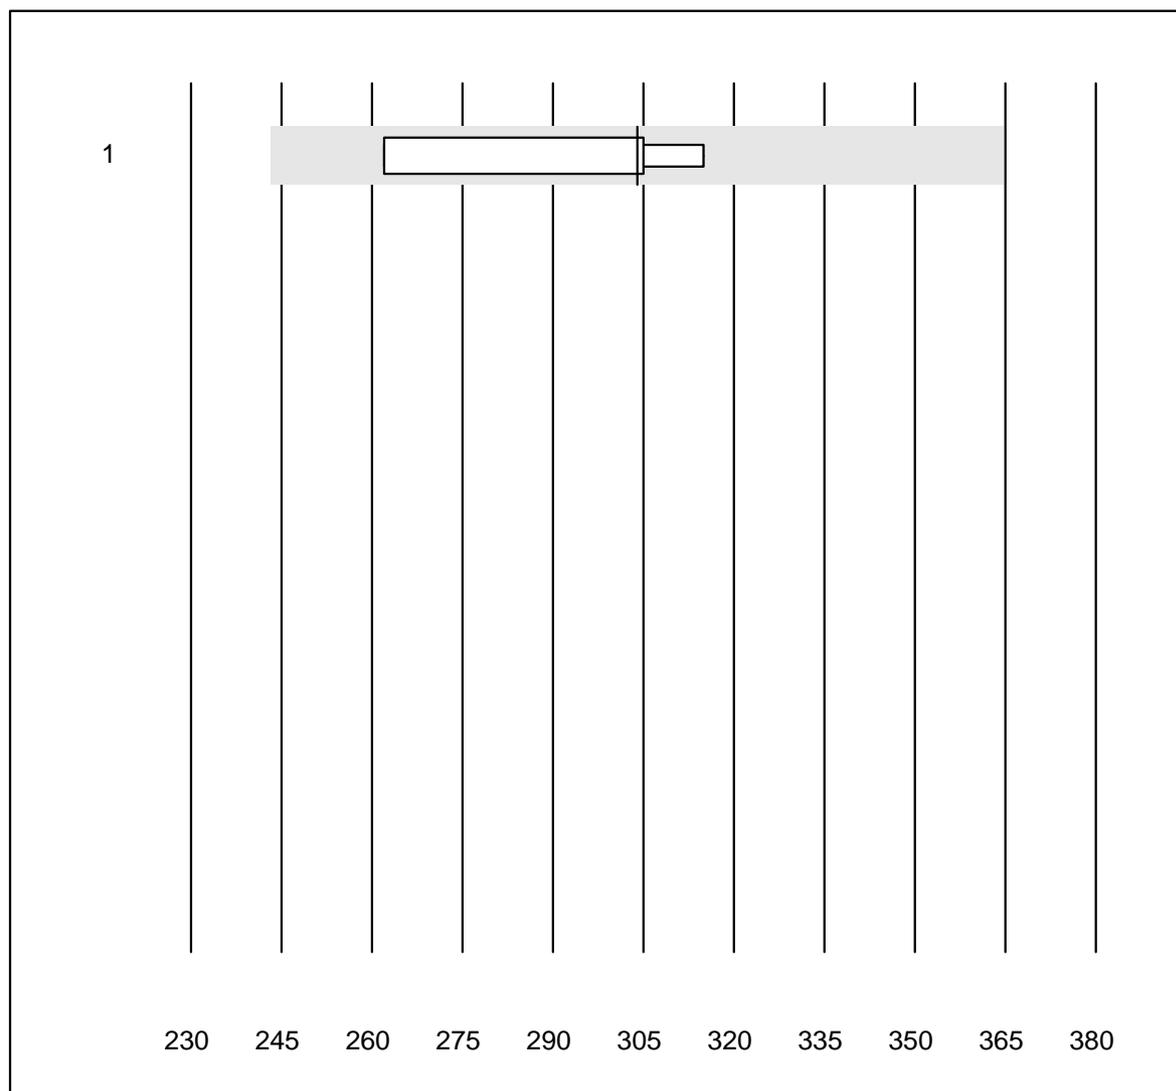


Tolérance MQ : 20 %

Albumine CSF (mg/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas	4	100.0	0.0	0.0	304.00	7.9	e*

Tacrolimus

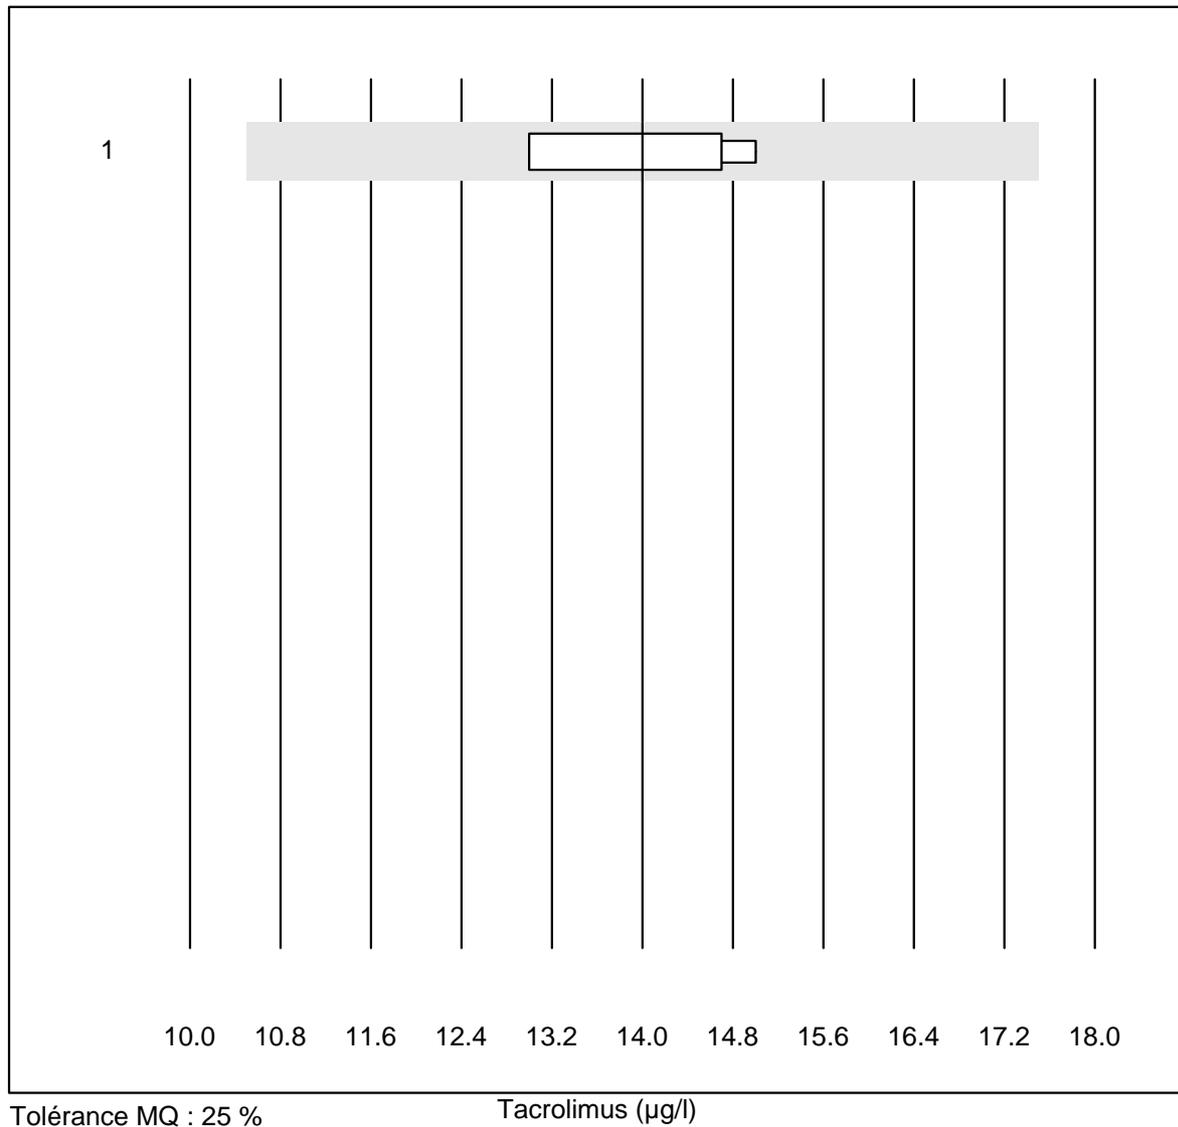

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	14.0	6.3	a

Totalprotein E

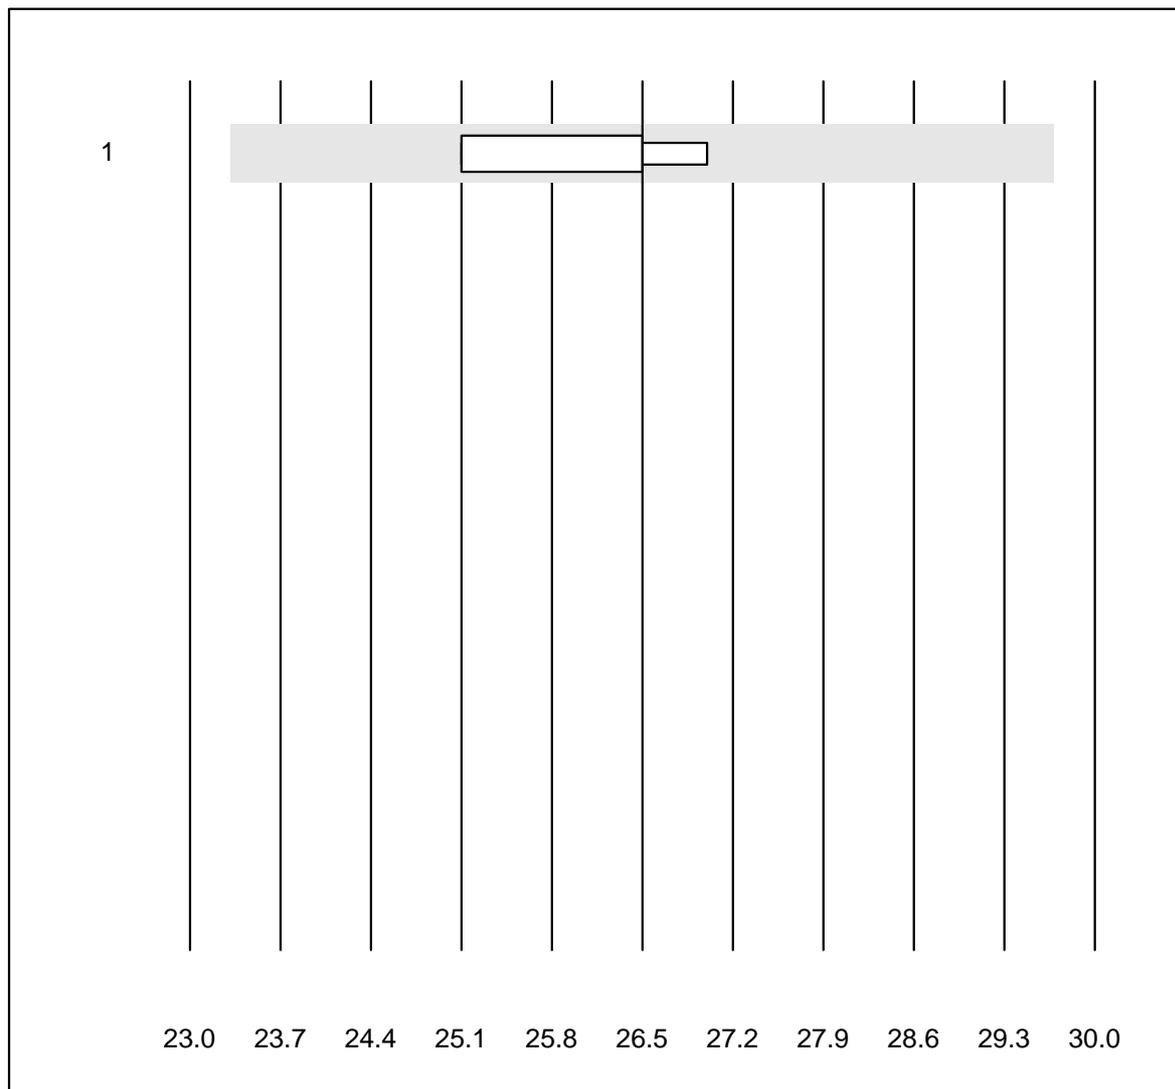


Tolérance MQ : 12 %

Totalprotein E (g/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	5	80.0	0.0	20.0	26.5	3.1	e

Albumin E

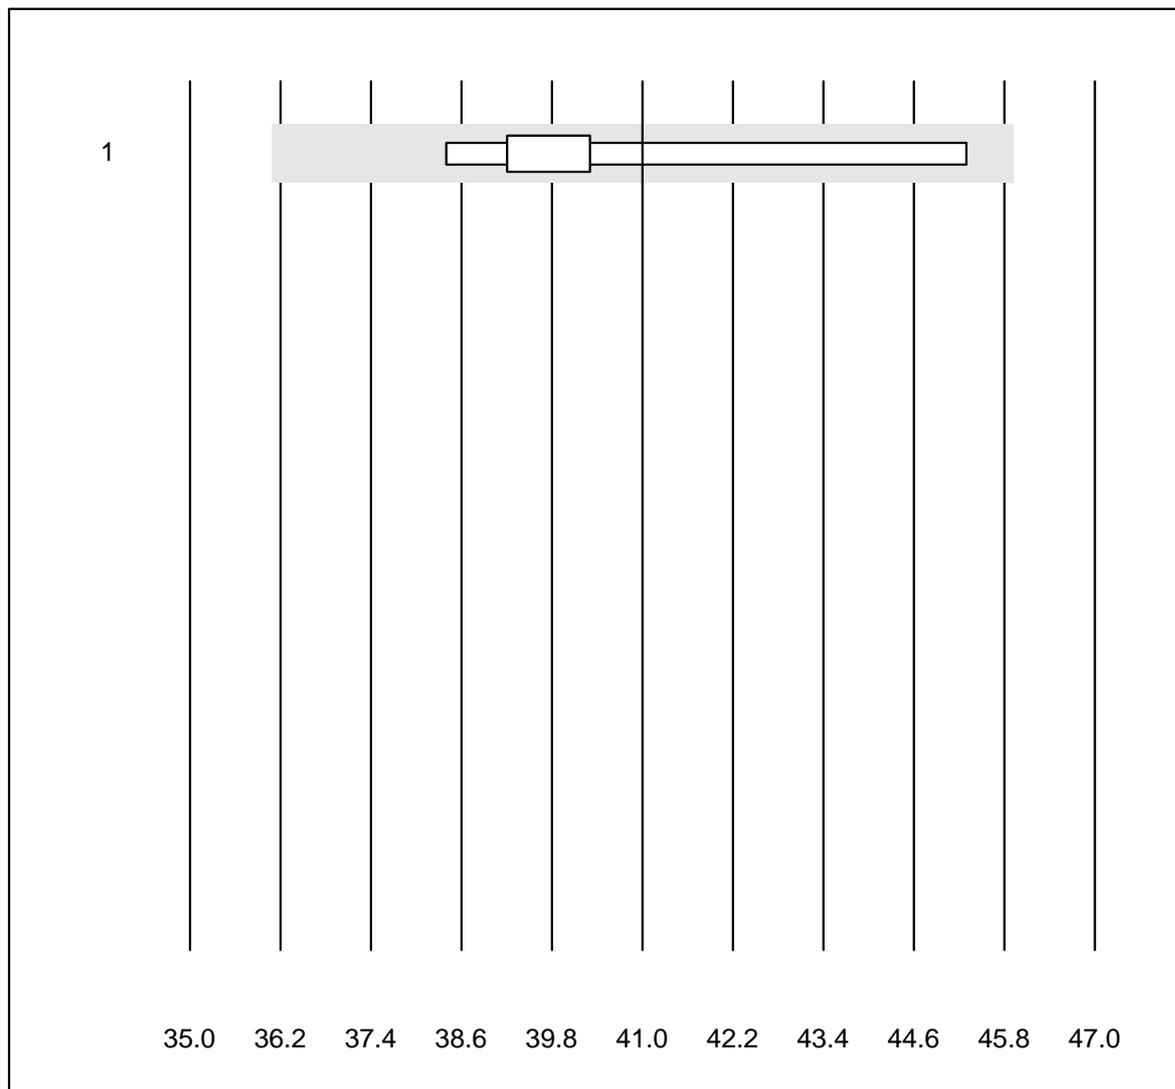


Tolérance MQ : 12 %

Albumin E (%)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 électrophorèse	10	90.0	0.0	10.0	41.0	5.1	a

alpha-1-Globuline

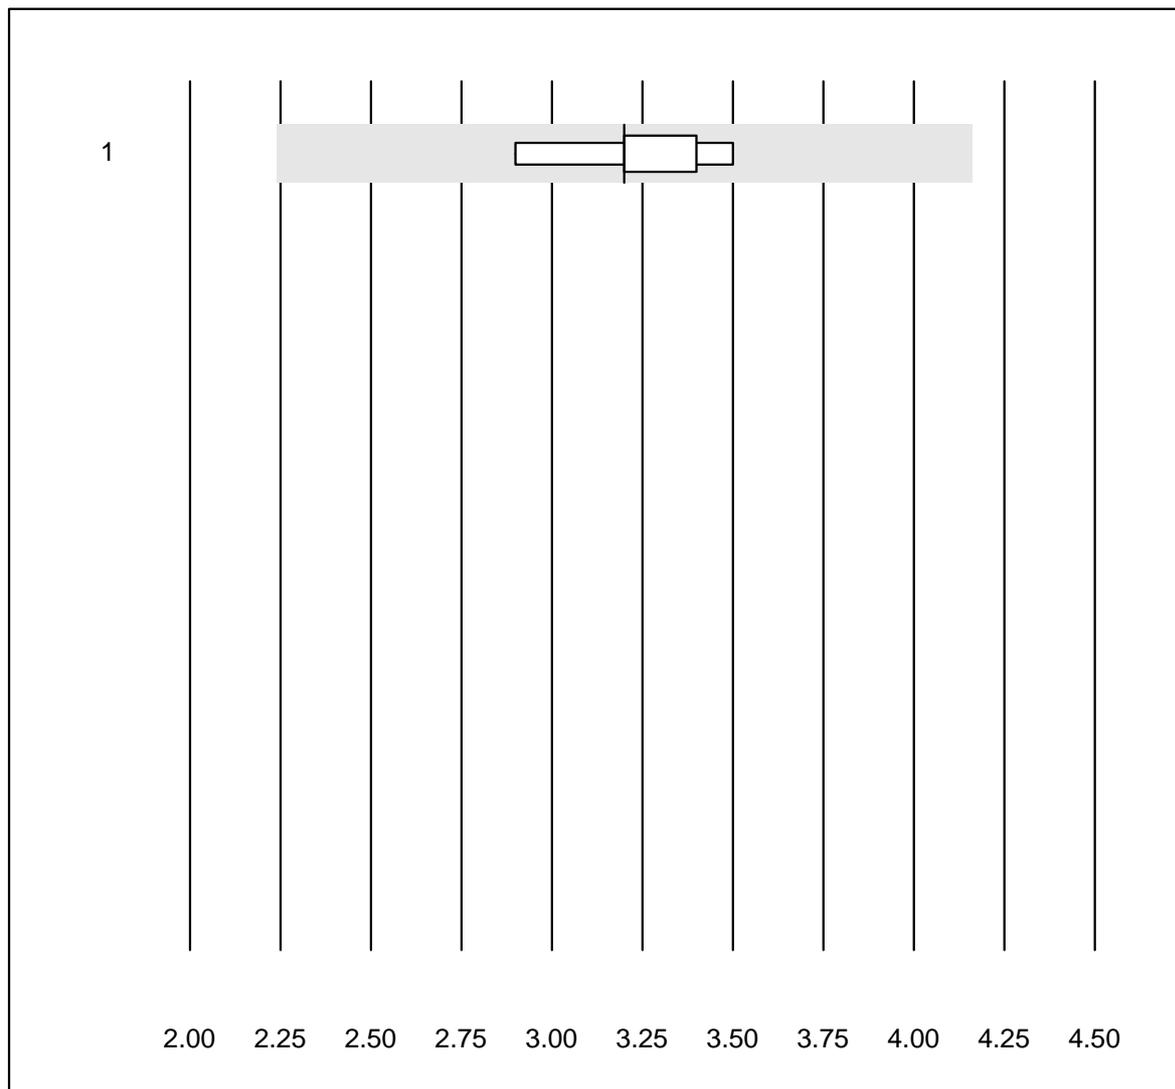


Tolérance MQ : 30 %

alpha-1-Globuline (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	électrophorèse capil	7	100.0	0.0	0.0	3.2	6.1	e

alpha-2-Globuline

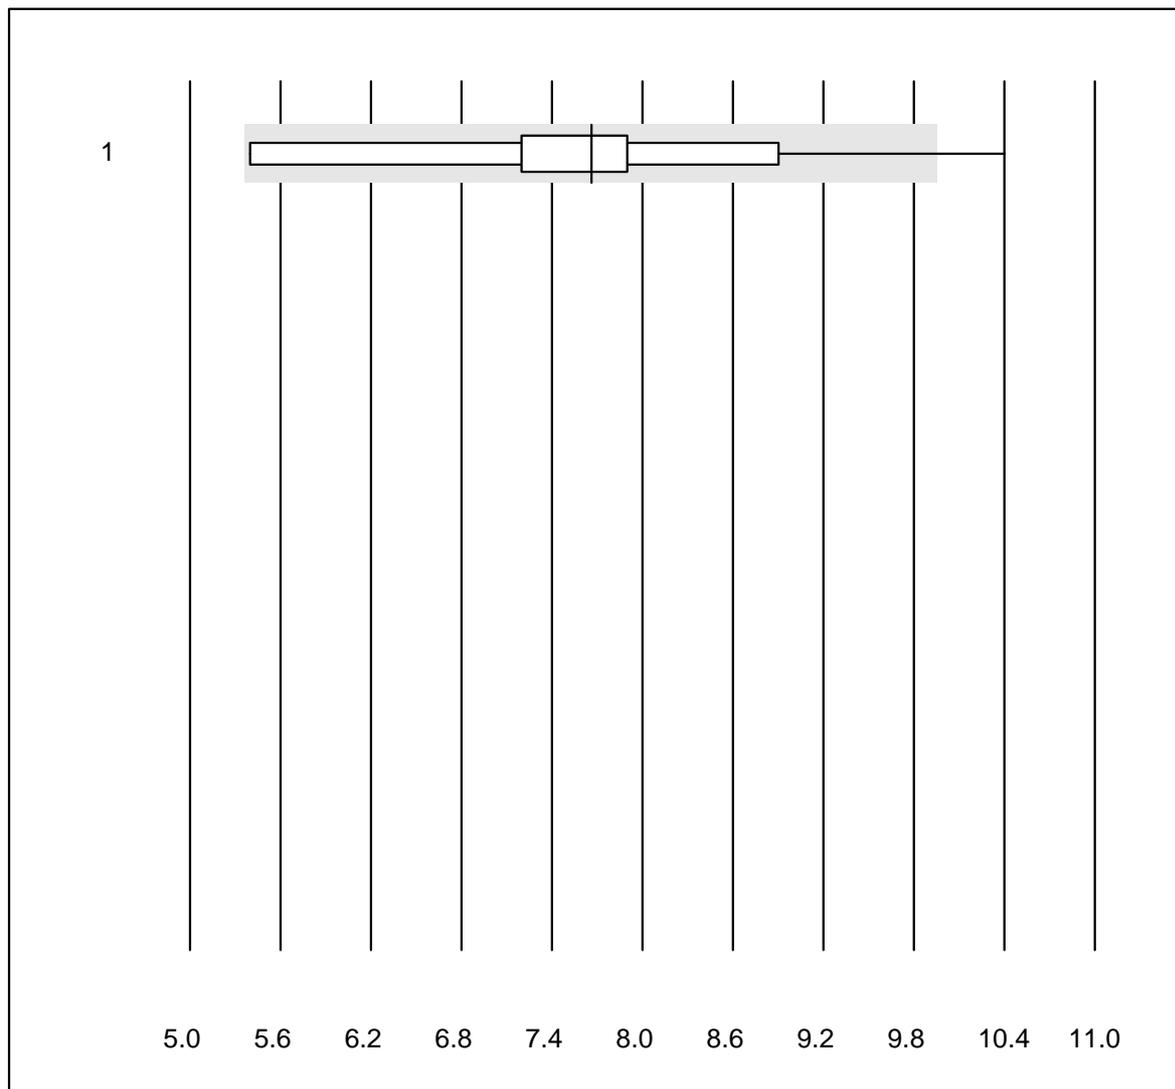


Tolérance MQ : 30 %

alpha-2-Globuline (%)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 électrophorèse	10	90.0	10.0	0.0	7.7	16.9	e*

beta-Globuline

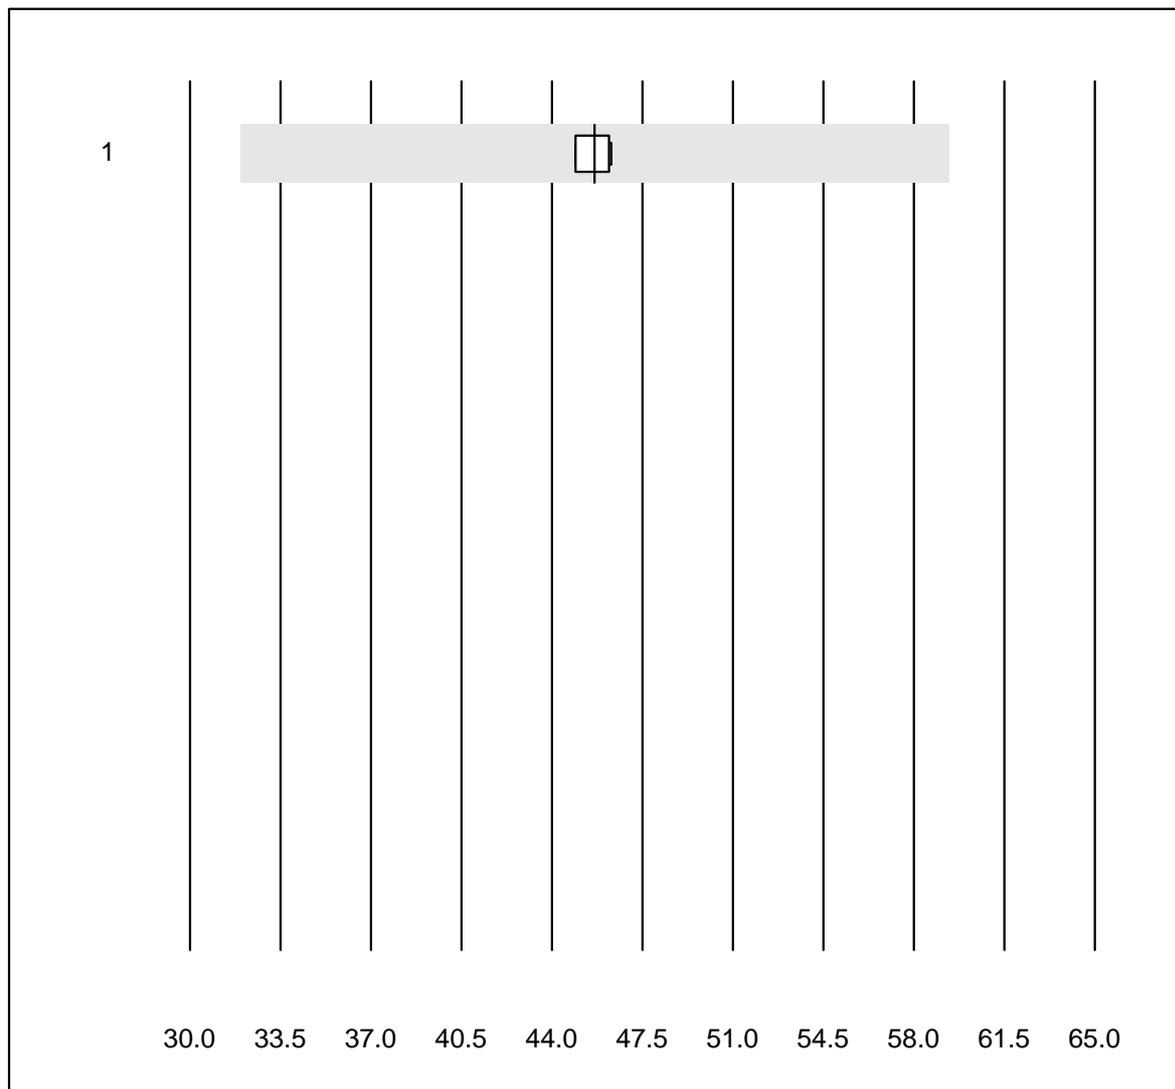


Tolérance MQ : 30 %

beta-Globuline (%)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 électrophorèse	4	100.0	0.0	0.0	45.7	1.6	e

Beta-1-Globulin

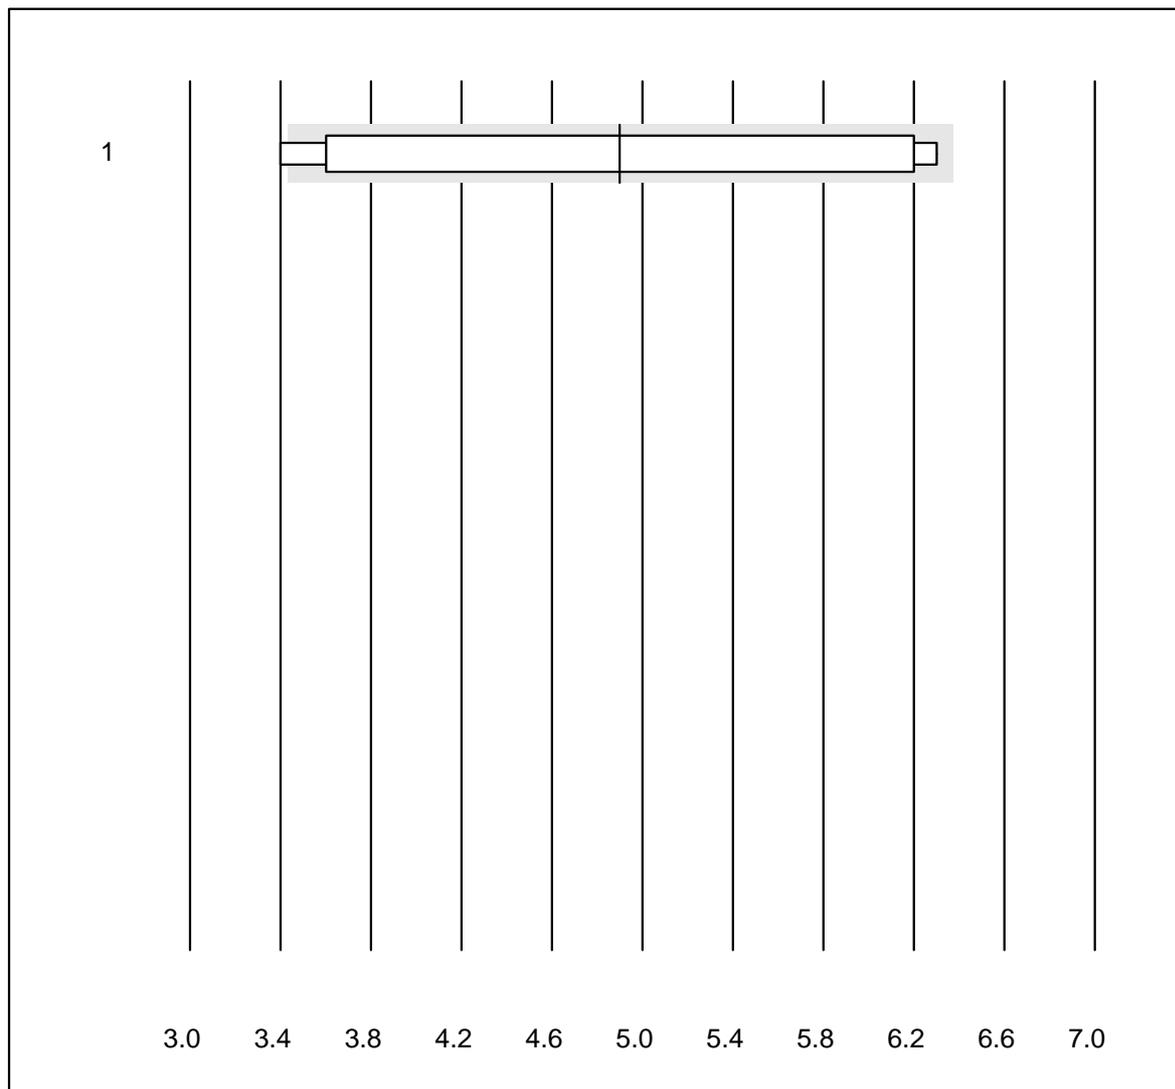


Tolérance MQ : 30 %

Beta-1-Globulin (%)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 électrophorèse	7	85.7	14.3	0.0	4.9	26.1	e*

gamma-Globuline

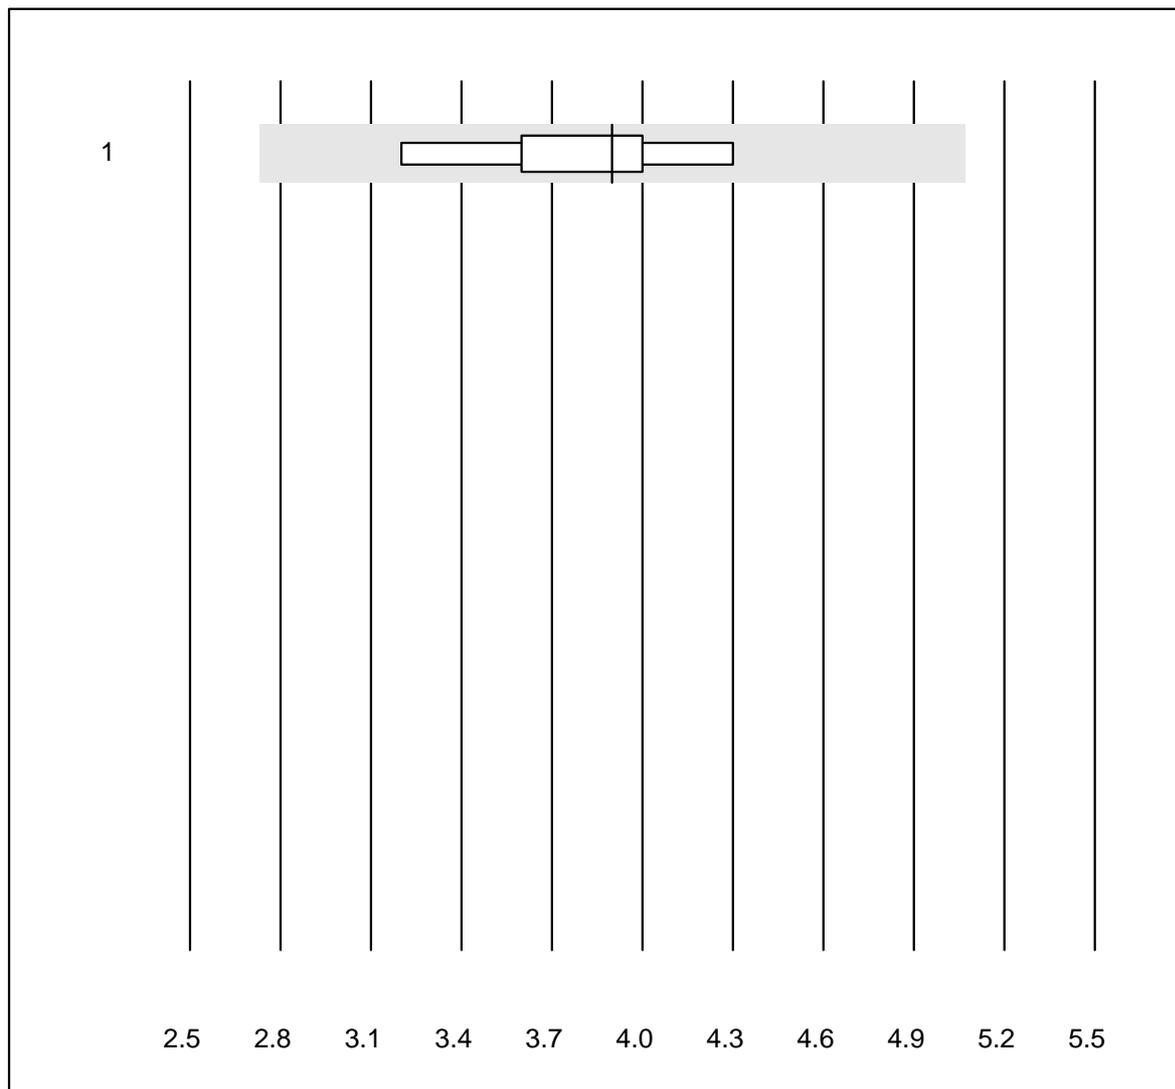


Tolérance MQ : 30 %

gamma-Globuline (%)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 électrophorèse	7	71.4	0.0	28.6	3.9	11.1	a

Immundefixation

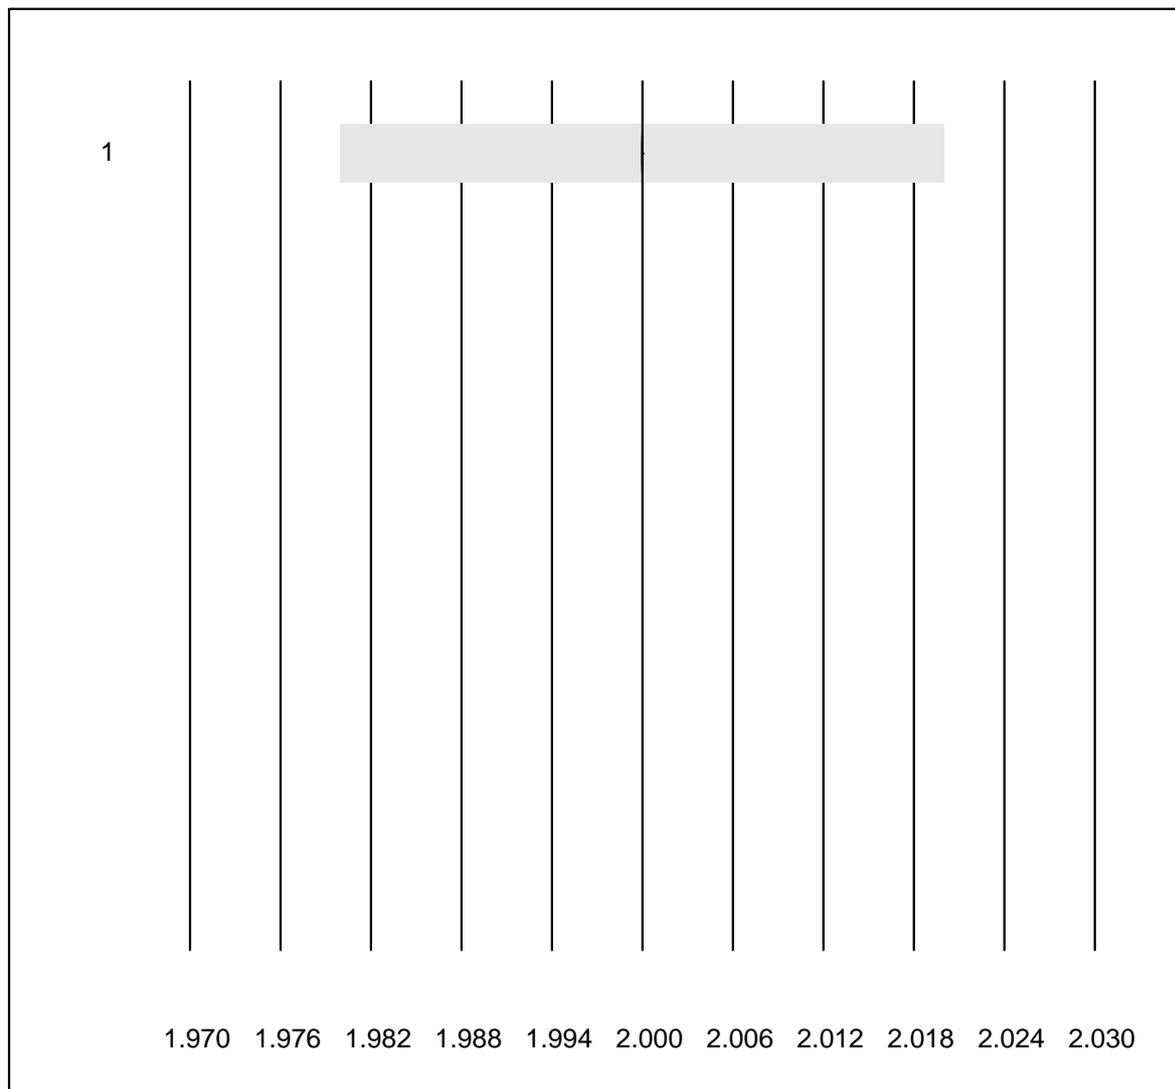


Tolérance MQ : 1 %

Immundefixation (Code)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Interpretation	7	100.0	0.0	0.0	2	0.0	e

Folates érythrocytaires

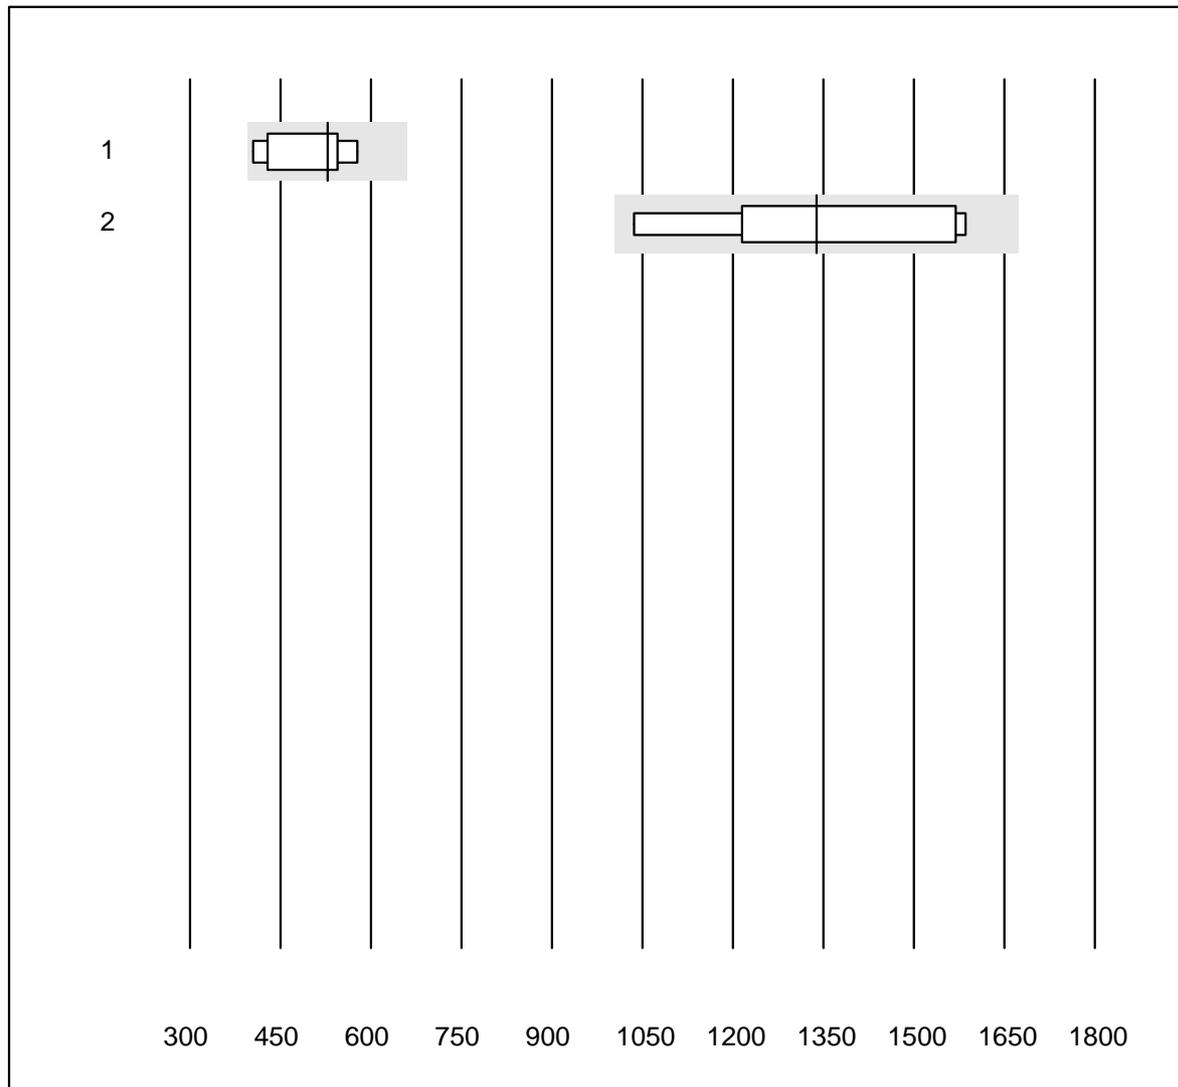


Tolérance MQ : 25 %

Folates érythrocytaires (nmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Architect	6	100.0	0.0	0.0	528	13.7	e*
2	Cobas	5	100.0	0.0	0.0	1339	17.6	a

HbA1c échantillon A

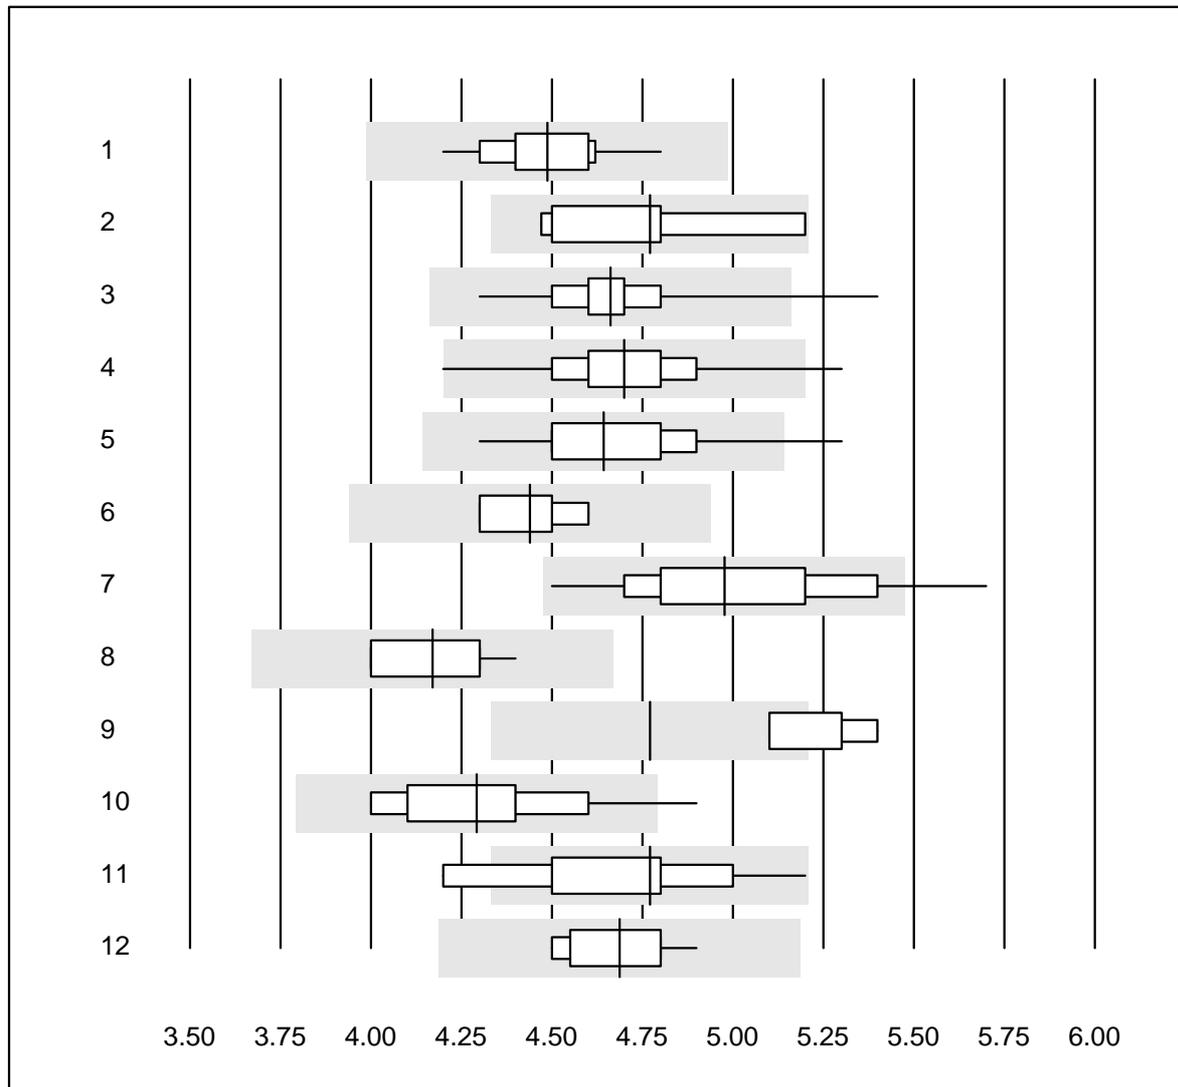


QUALAB Toleranz : 9 %
(< 5.0: +/- 0.5 %)

HbA1c échantillon A (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Roche, Cobas	11	100.0	0.0	0.0	4.5	3.7	e*
2	HPLC	8	100.0	0.0	0.0	4.8	5.1	a
3	Afinion	573	98.1	1.2	0.7	4.7	2.9	e
4	Cobas b101	103	96.1	3.9	0.0	4.7	4.1	e
5	DCA2000/Vantage	169	97.0	1.8	1.2	4.6	3.8	e
6	Celltac chemi	15	100.0	0.0	0.0	4.4	2.7	e
7	NycoCard	43	86.0	9.3	4.7	5.0	6.1	e
8	Eurolyser	10	100.0	0.0	0.0	4.2	3.4	e
9	Hemocue HbA1c 501	6	50.0	33.3	16.7	4.8	2.5	a
10	AFIAS	50	92.0	8.0	0.0	4.3	5.4	e
11	Andere	15	86.7	13.3	0.0	4.8	5.9	a
12	Spinit	11	100.0	0.0	0.0	4.7	3.0	e

HbA1c échantillon B

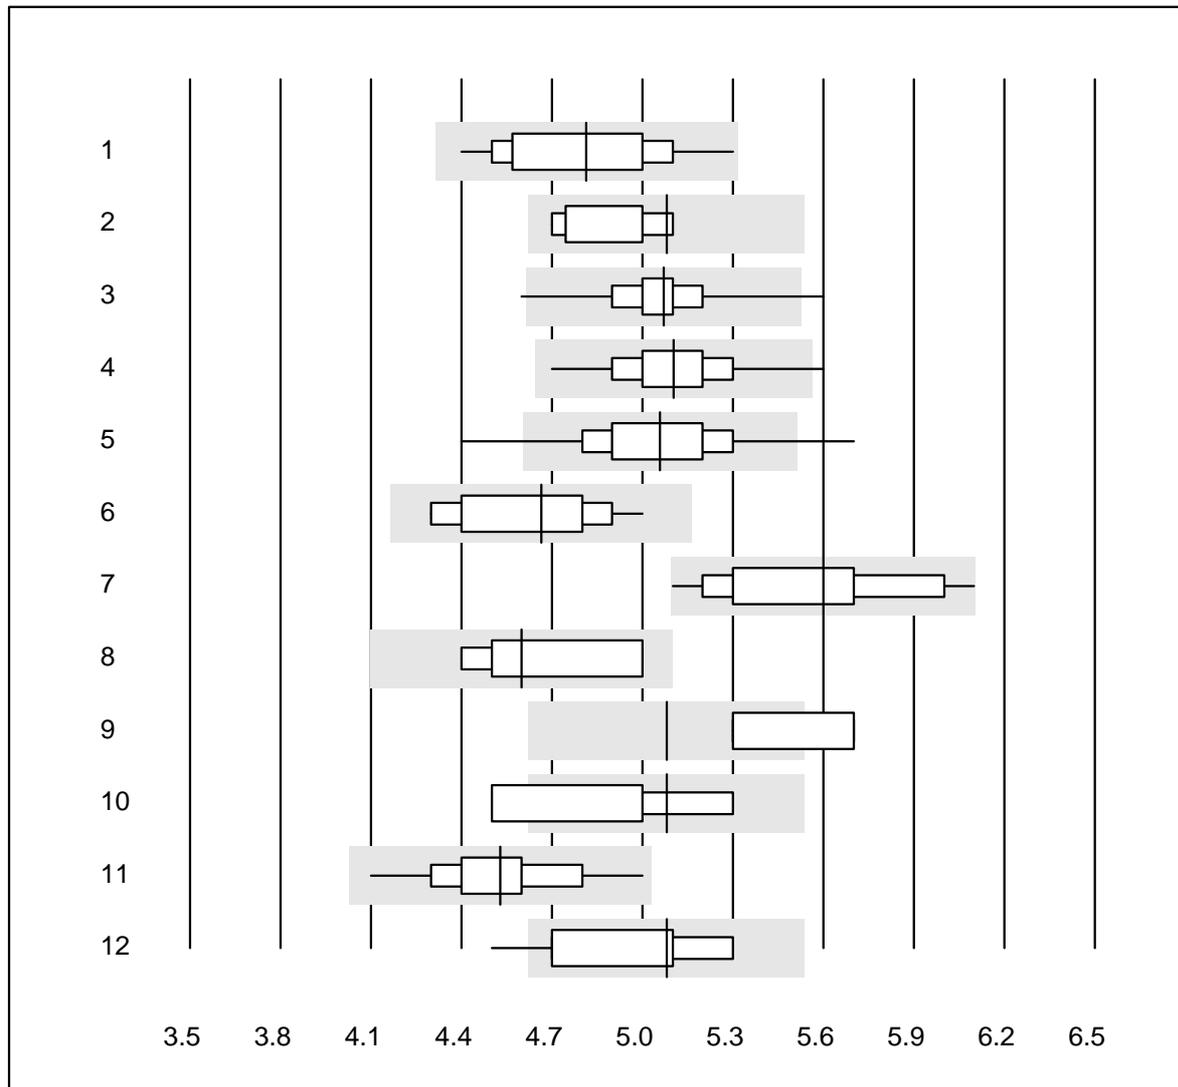


QUALAB Toleranz : 9 %
(< 5.0: +/- 0.5 %)

HbA1c échantillon B (%)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Roche, Cobas	13	100.0	0.0	0.0	4.8	5.7	e*
2	HPLC	8	100.0	0.0	0.0	5.1	2.7	a
3	Afinion	755	99.1	0.4	0.5	5.1	2.6	e
4	Cobas b101	109	99.1	0.9	0.0	5.1	3.5	e
5	DCA2000/Vantage	218	94.0	3.7	2.3	5.1	4.0	e
6	Celltac chemi	14	100.0	0.0	0.0	4.7	5.0	e*
7	NycoCard	20	95.0	0.0	5.0	5.6	5.2	e*
8	Eurolyser	9	100.0	0.0	0.0	4.6	5.5	e*
9	Hemocue HbA1c 501	6	16.7	33.3	50.0	5.1	4.1	a
10	A1c Now	4	75.0	25.0	0.0	5.1	6.7	a
11	AFIAS	68	100.0	0.0	0.0	4.5	4.4	e
12	Andere	13	76.9	7.7	15.4	5.1	5.1	a

Gallensäure

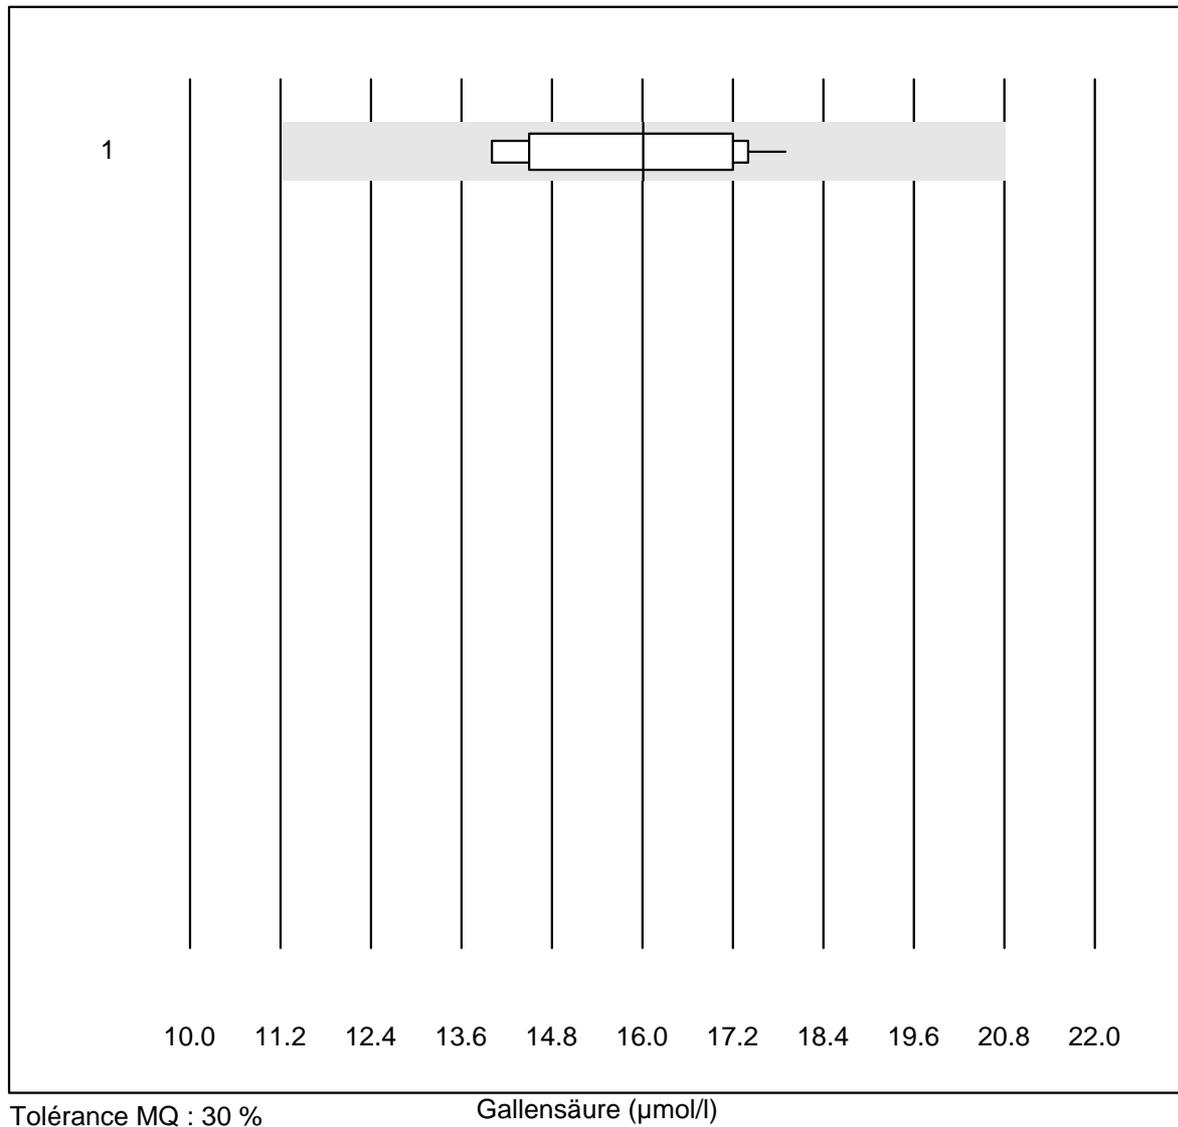

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	10	100.0	0.0	0.0	16.0	9.5	e

BNP

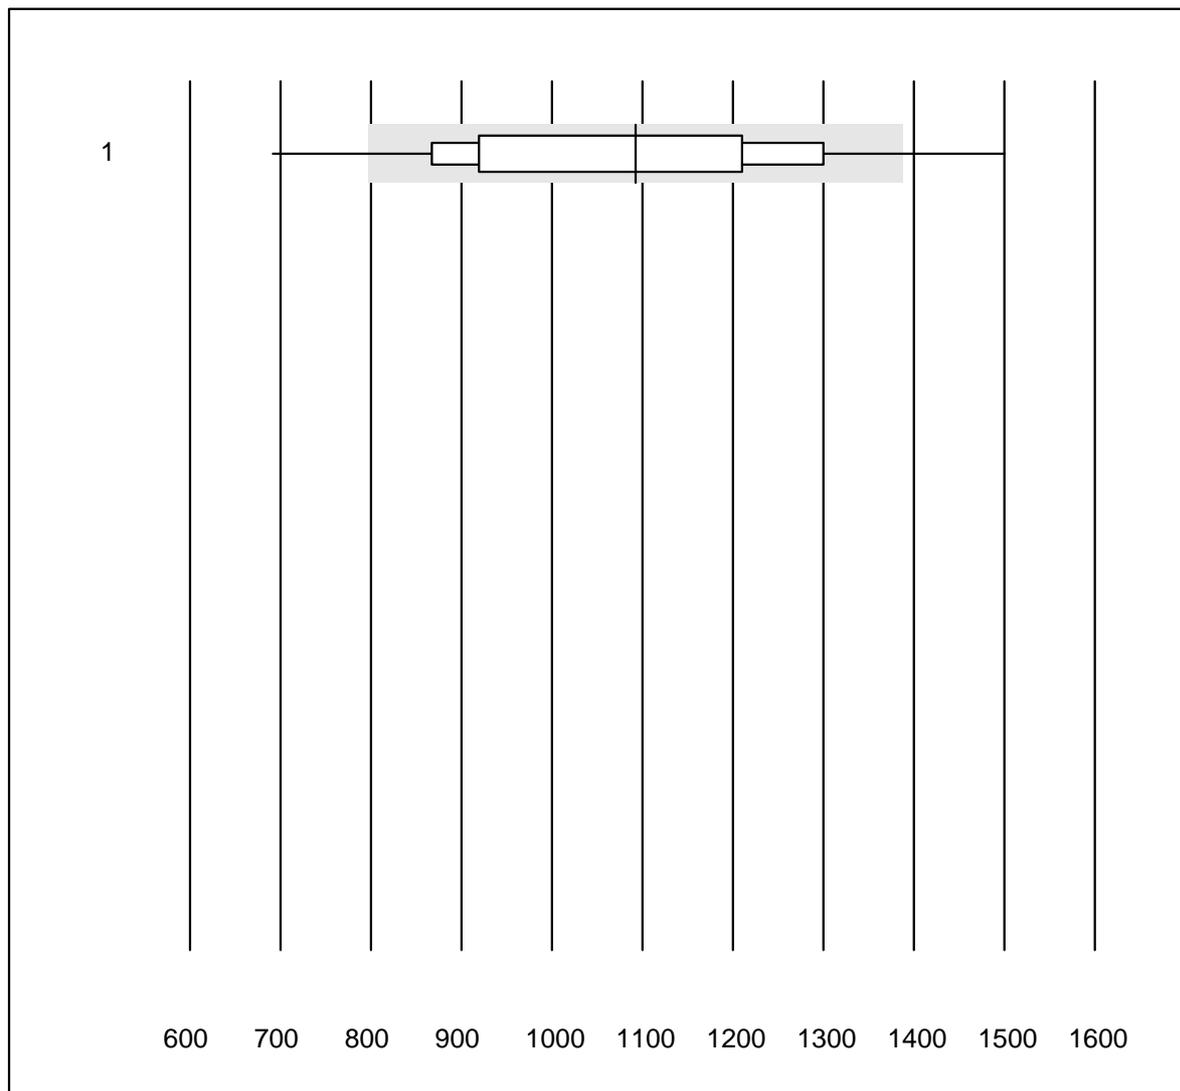


QUALAB Toleranz : 27 %

BNP (ng/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Triage	25	84.0	8.0	8.0	1092.8	17.3	e*

Troponin Triage

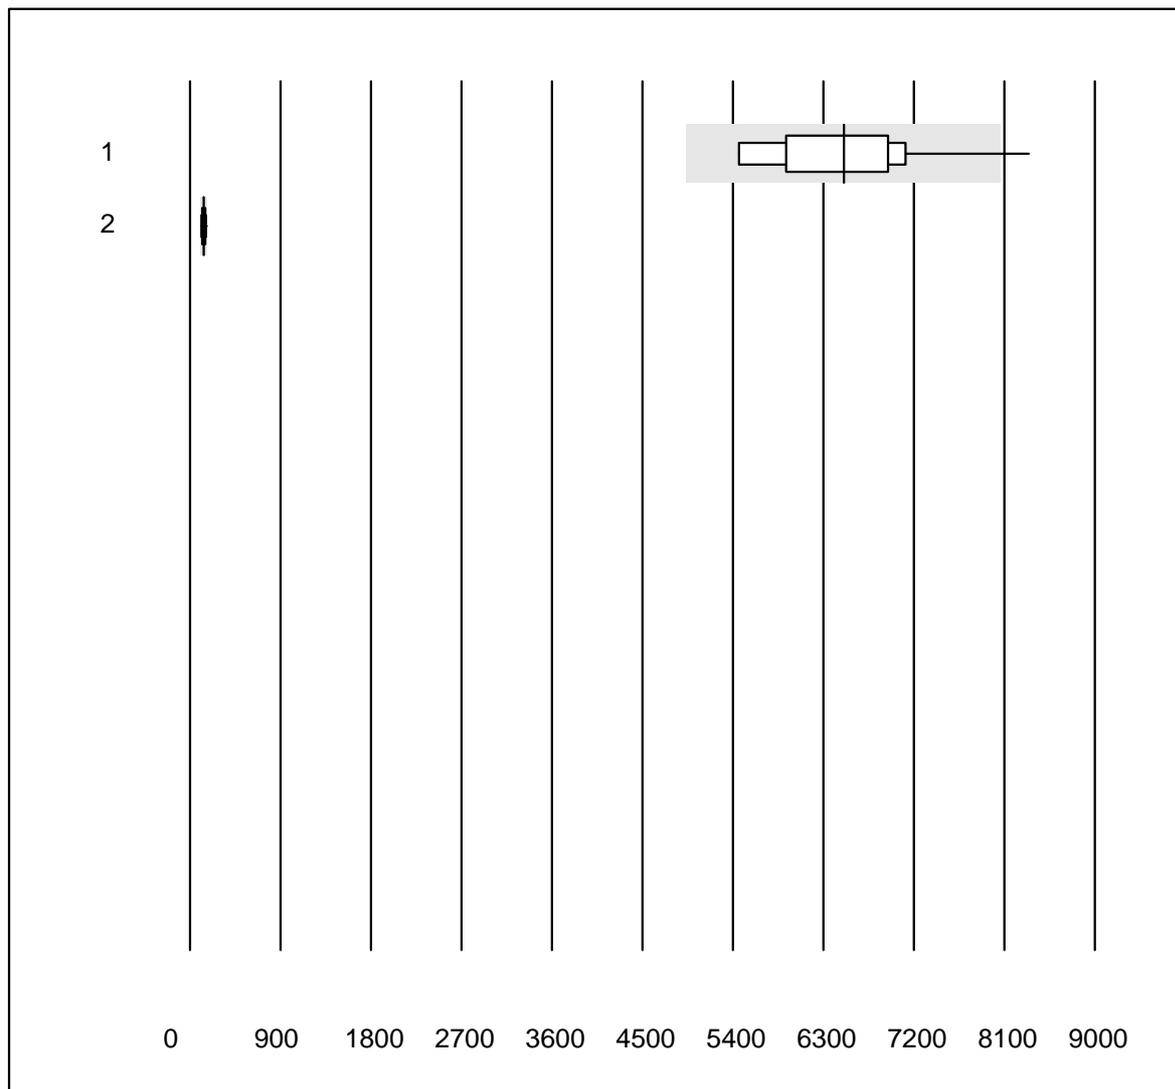


QUALAB Toleranz : 24 %

Troponin Triage (ng/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Triage SOB/Cardiac	14	64.3	7.1	28.6	6501.00	12.8	e*
2	Triage Next Gen	22	41.0	4.5	54.5	136.00	14.0	e*

NT-pro BNP

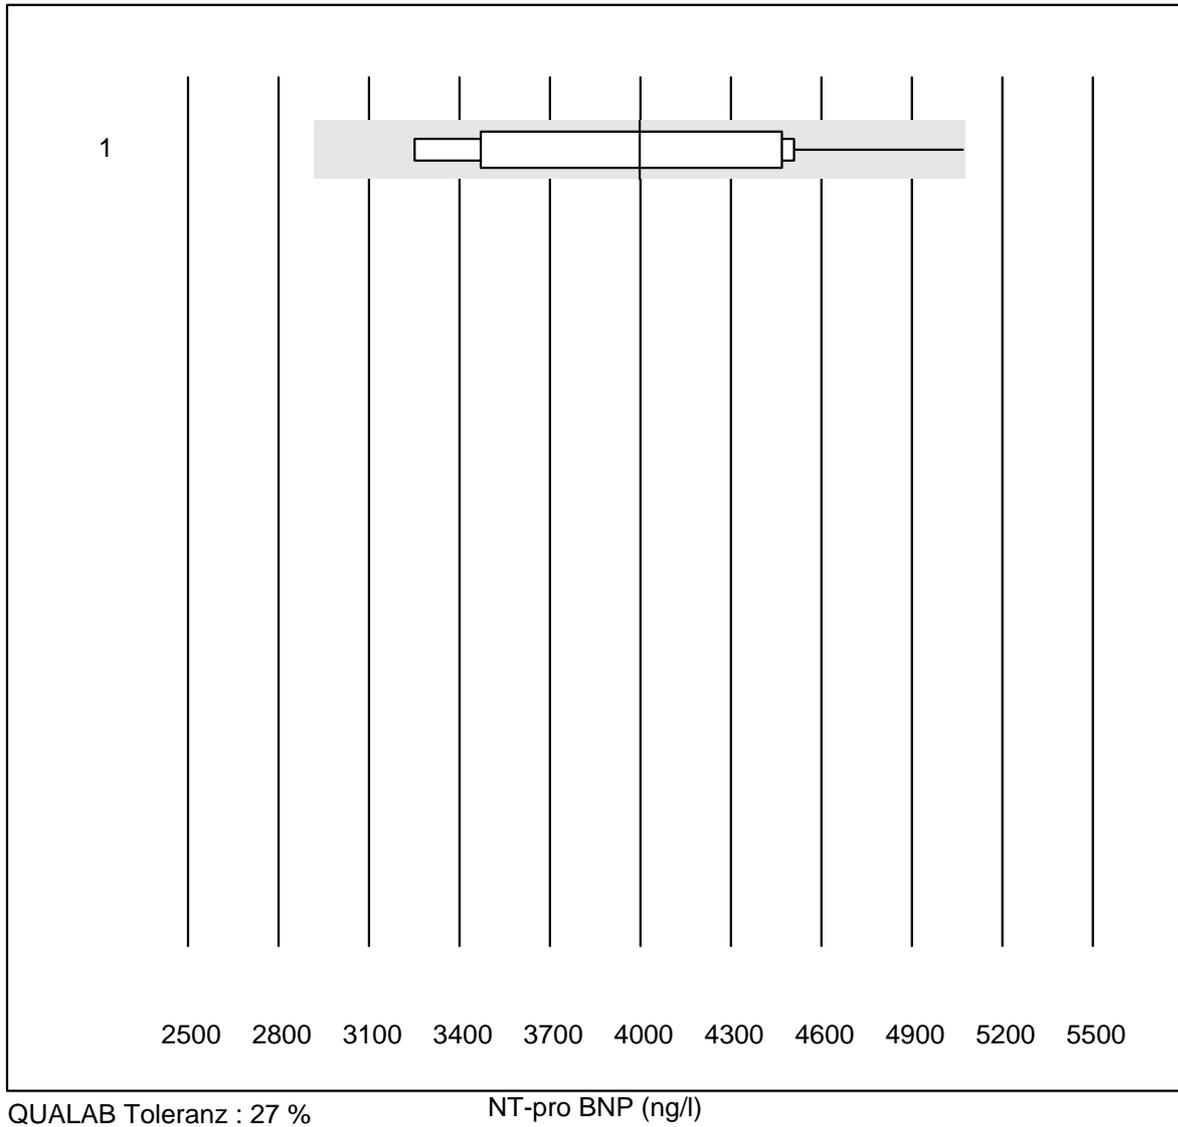

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Triage	12	83.3	0.0	16.7	3998	15.0	e*

D-Dimere Triage

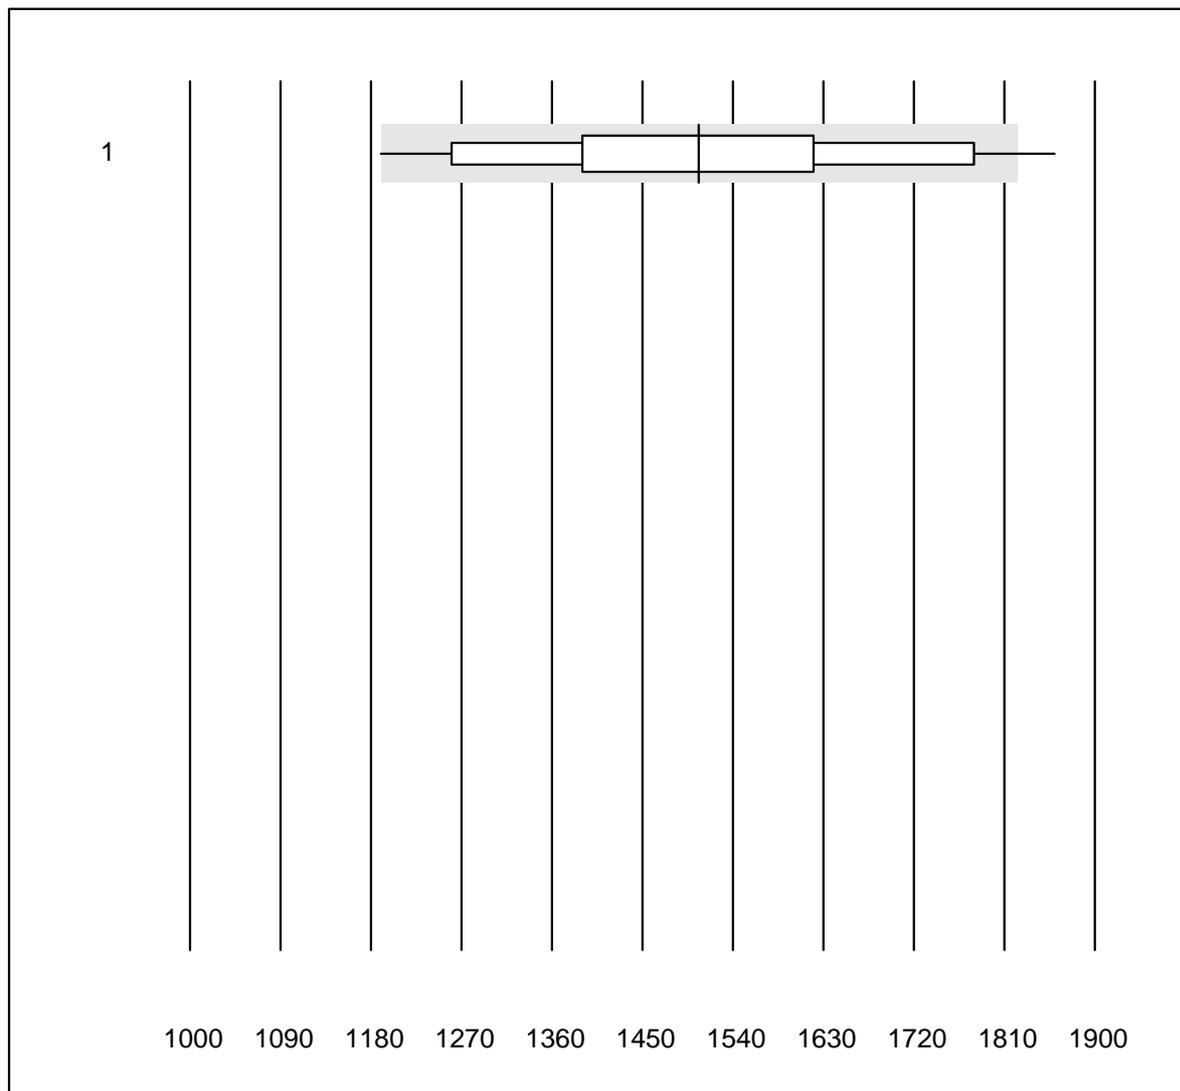


QUALAB Toleranz : 21 %

D-Dimere Triage (ng/ml)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Triage	38	94.8	2.6	2.6	1506.22	11.4	e

CK-MB Triage

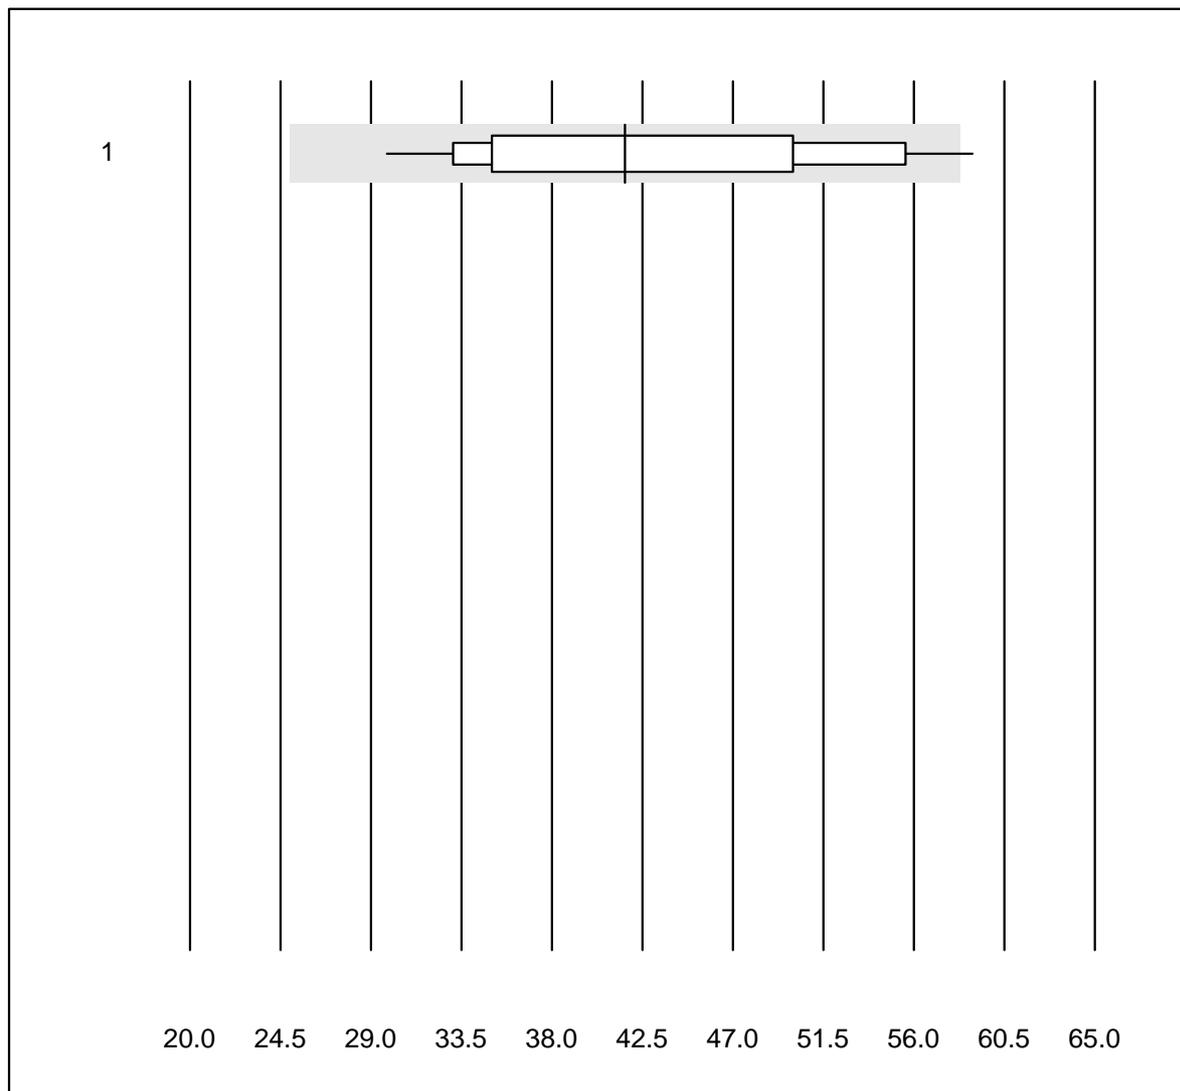


Tolérance MQ : 40 %

CK-MB Triage (µg/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Triage	14	92.9	7.1	0.0	41.6	22.6	e*

Myoglobin Triage

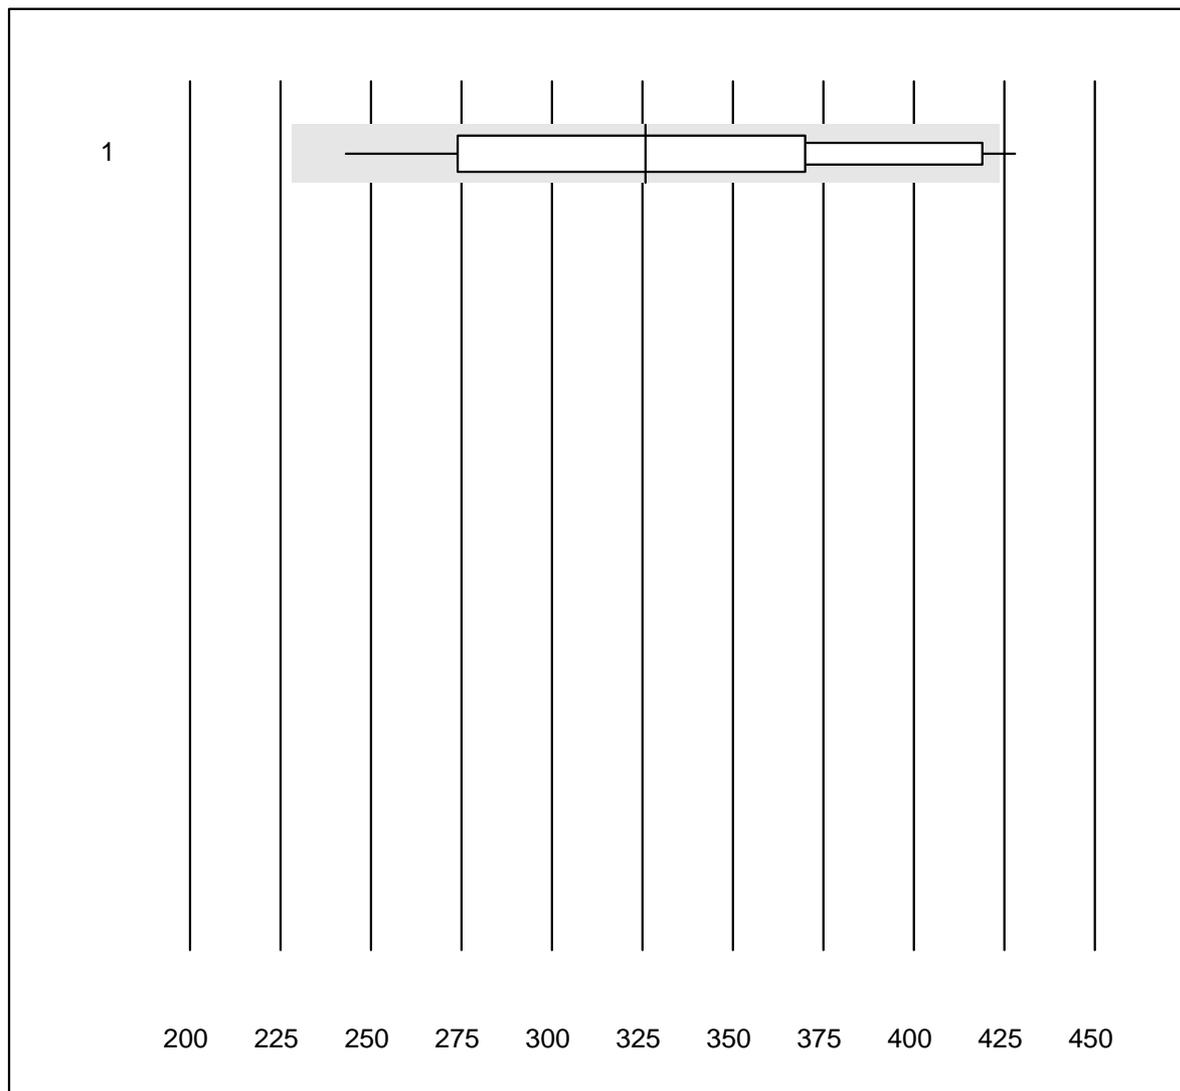


QUALAB Toleranz : 30 %

Myoglobin Triage (µg/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Triage	11	90.9	9.1	0.0	325.9	19.0	e*

25-OH Vitamin D

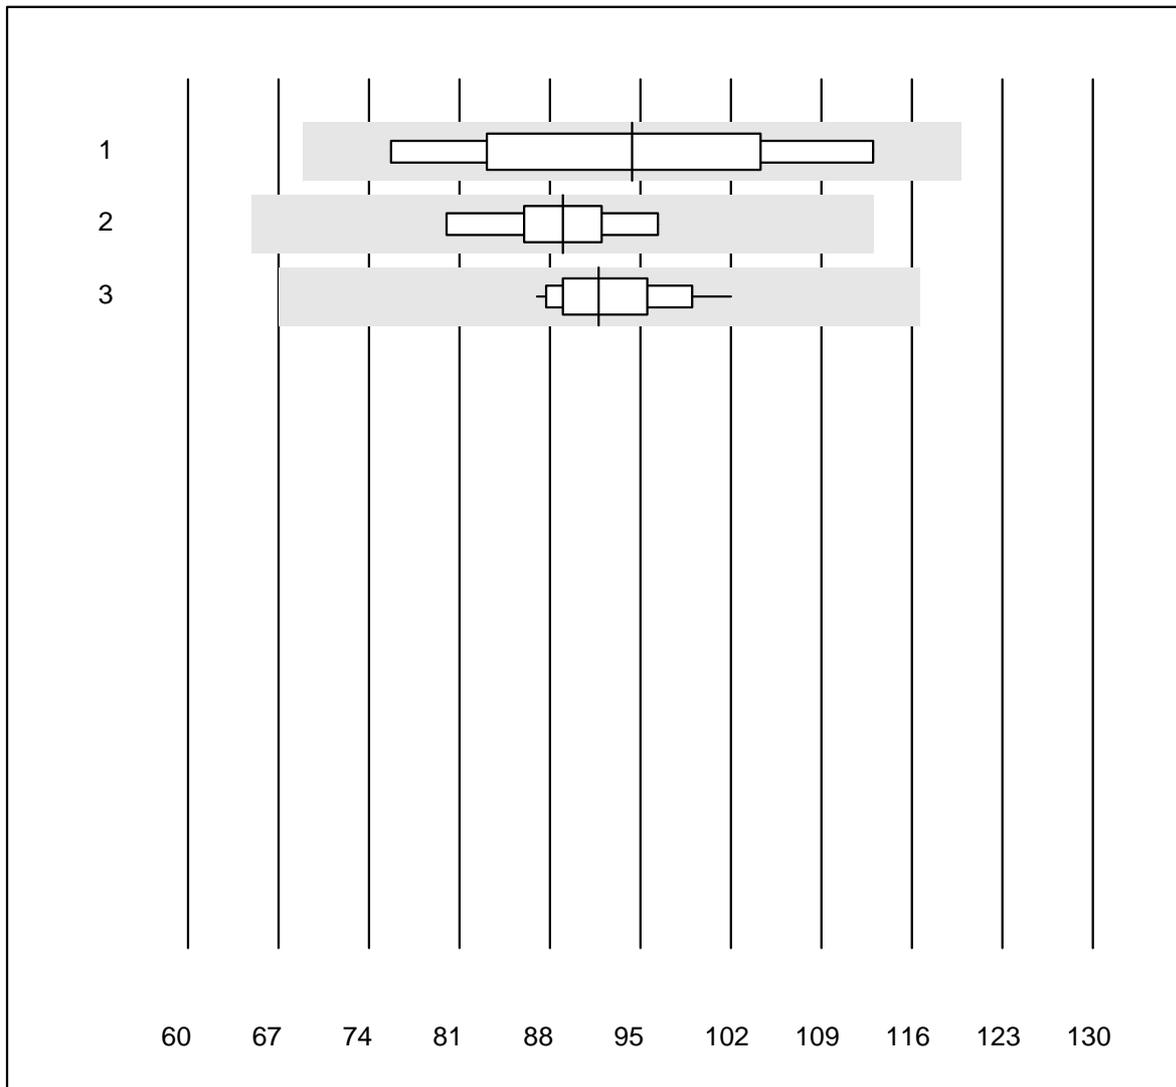


QUALAB Toleranz : 27 %

25-OH Vitamin D (nmol/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	6	100.0	0.0	0.0	94.4	15.7	a
2 VIDAS	9	100.0	0.0	0.0	89.0	6.0	e
3 Architect	11	100.0	0.0	0.0	91.8	5.3	e

AMH

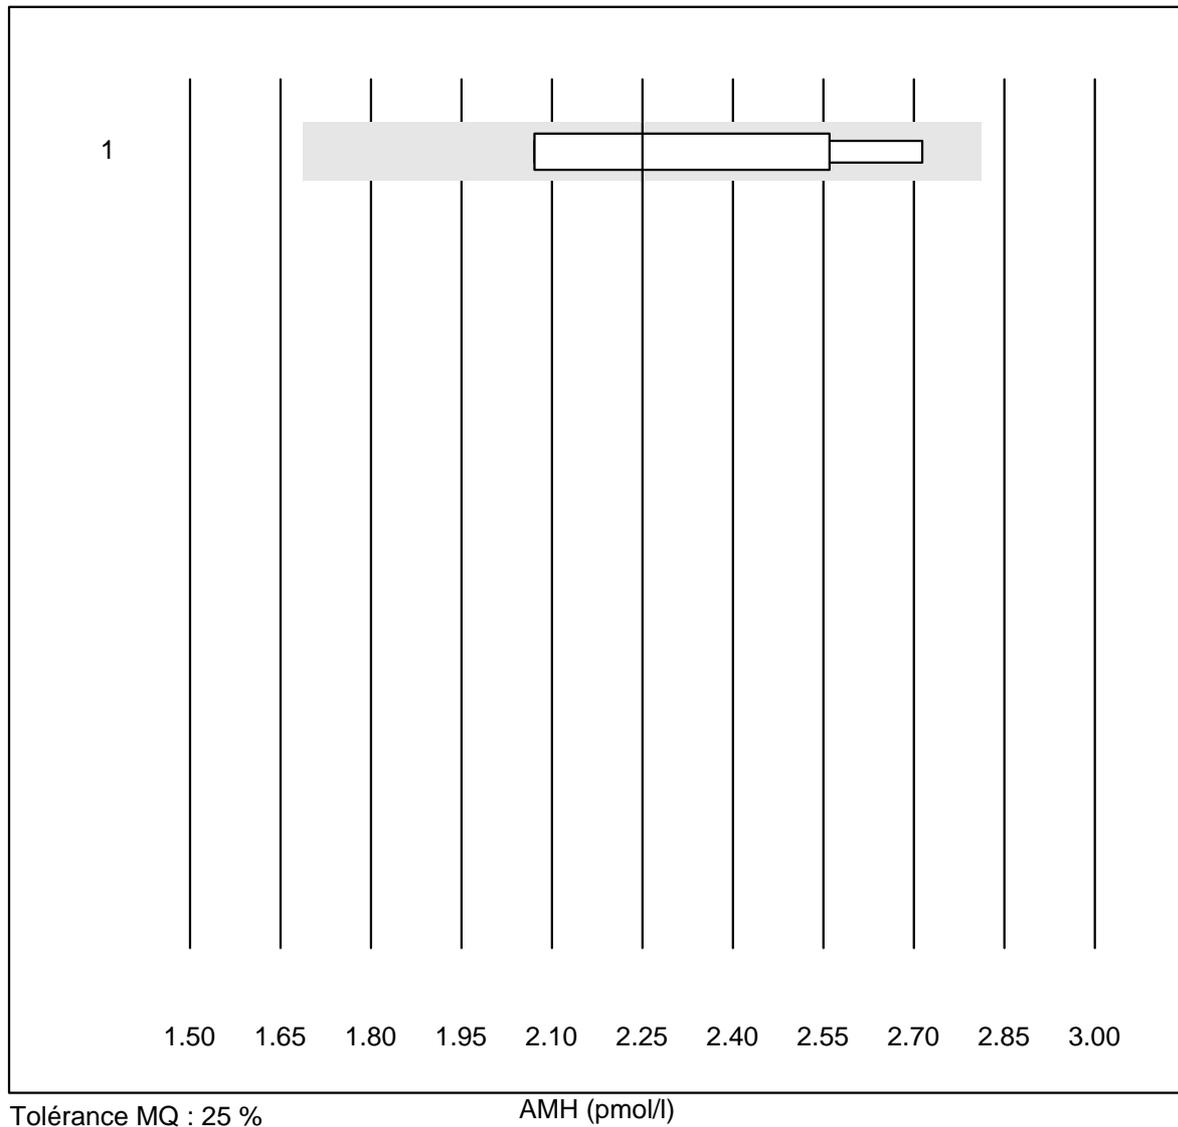


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	2.3	11.4	e*

Calcitonin

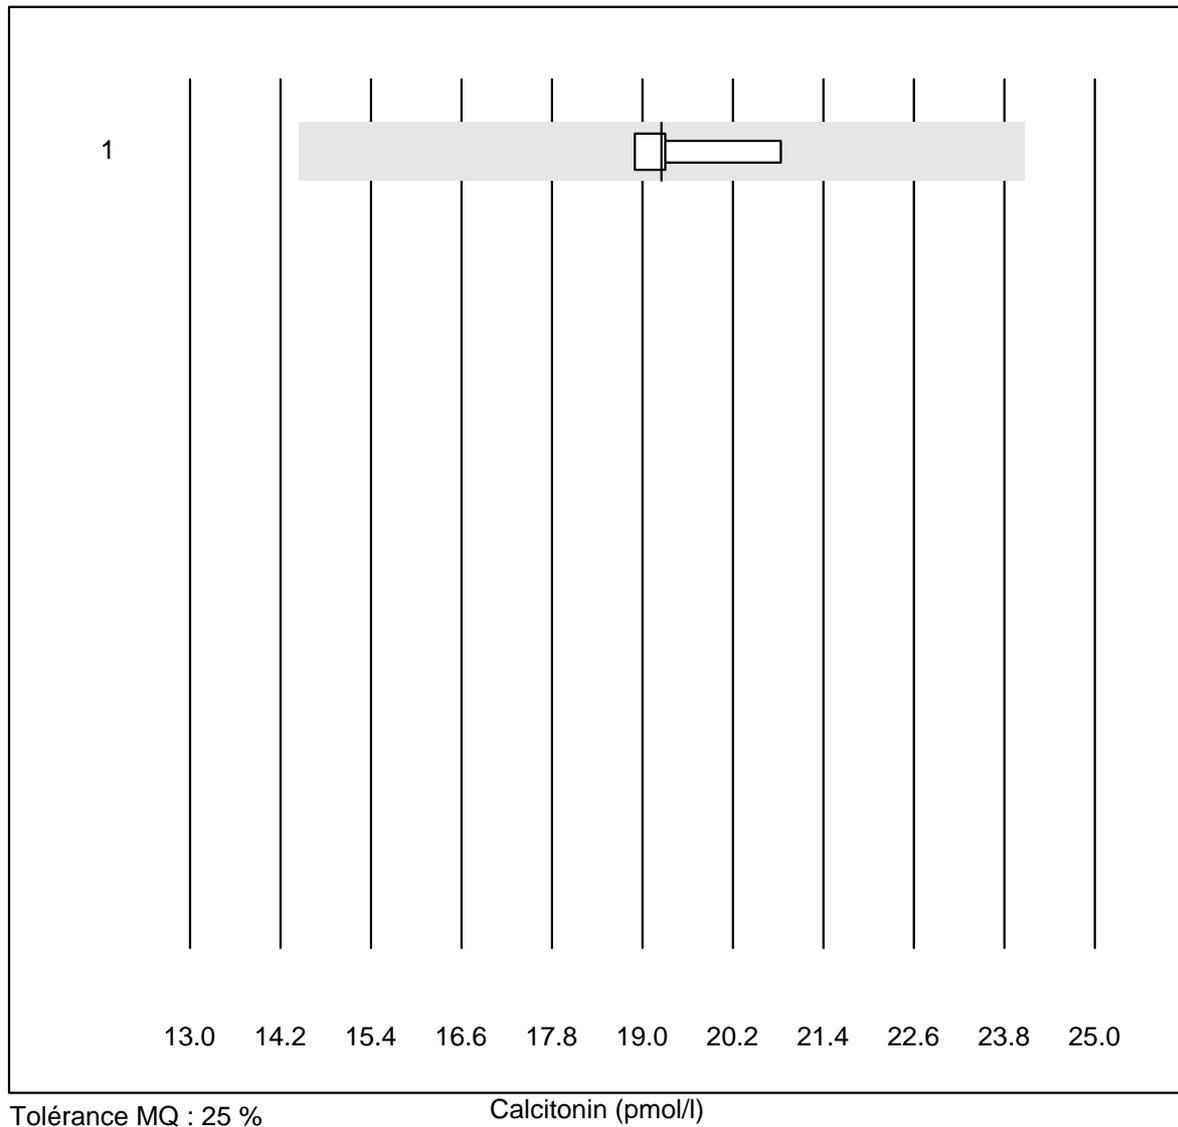


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	19.3	4.4	e

IGF-BP3

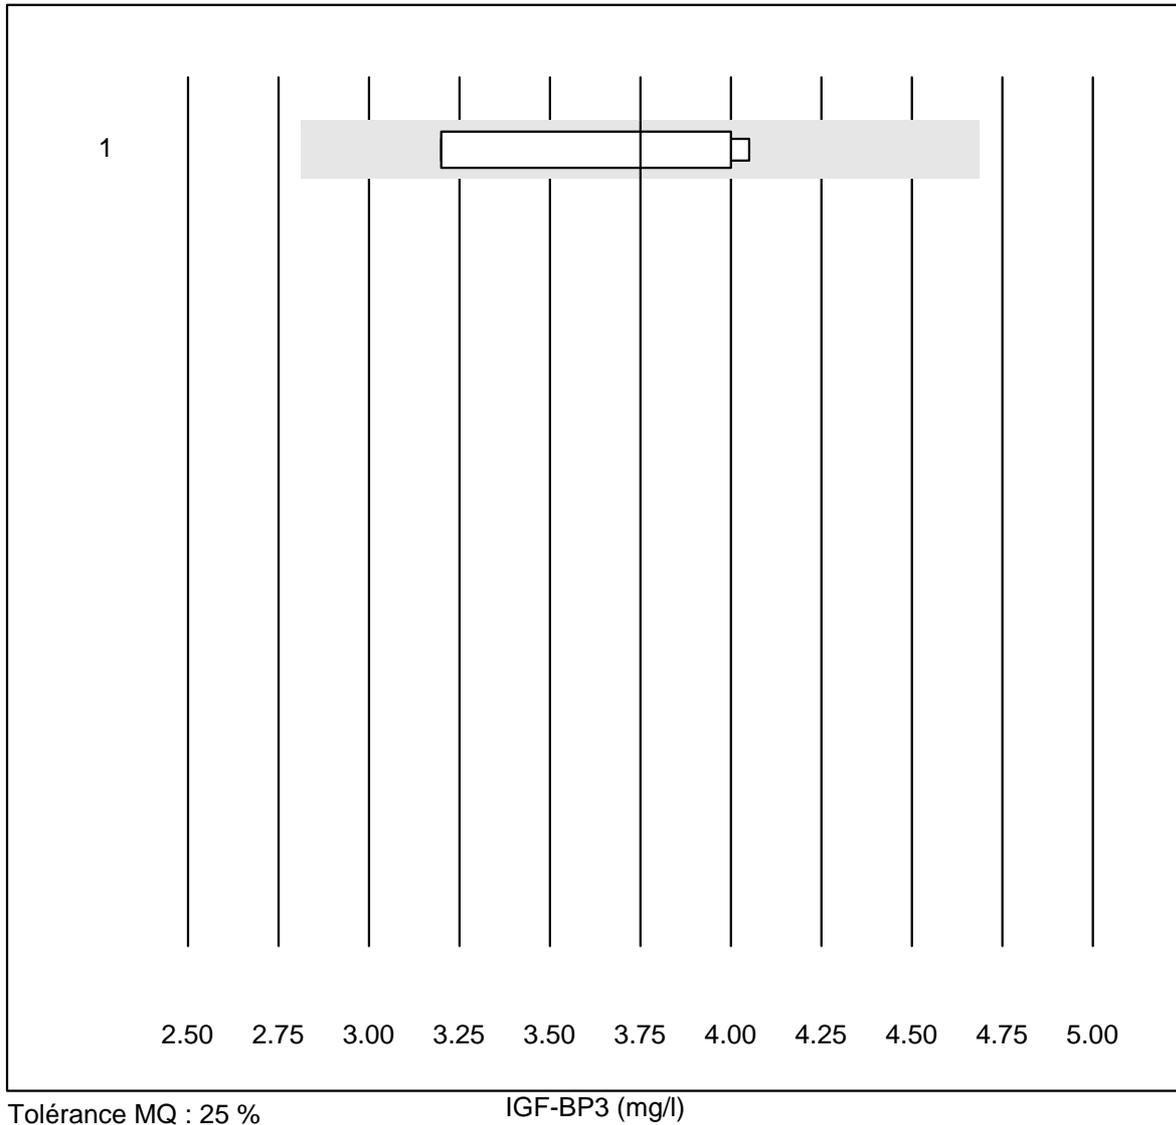

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	3.75	11.1	e*

Anti Thyreoglobulin

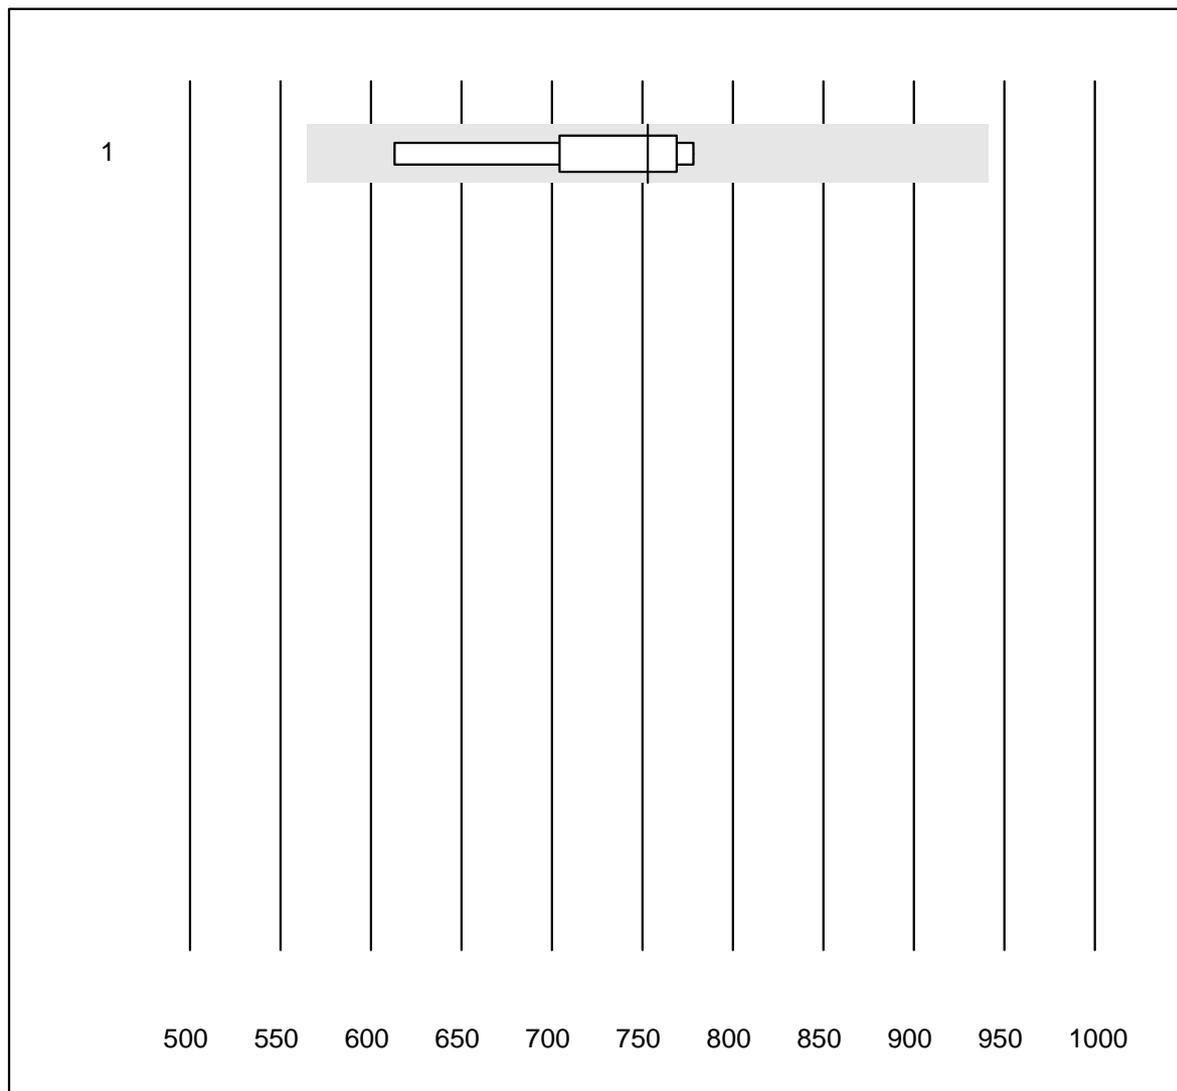


Tolérance MQ : 25 %

Anti Thyreoglobulin (IU/ml)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	753	9.4	e*

Anti TPO

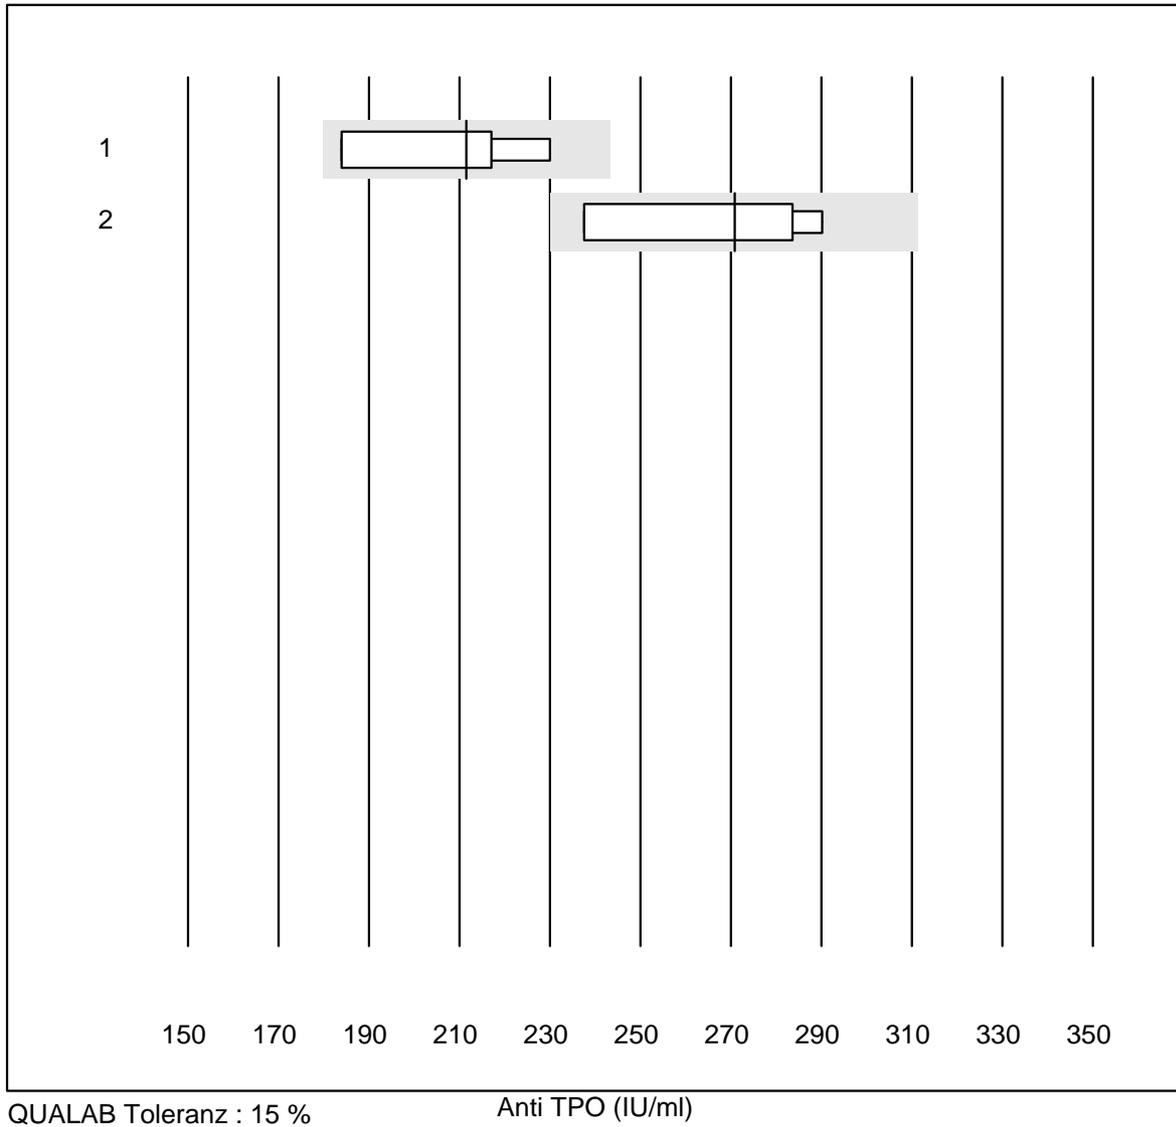


QUALAB Toleranz : 15 %

Anti TPO (IU/ml)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	212	9.3	e*
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	271	9.1	e*

Créatinine WB

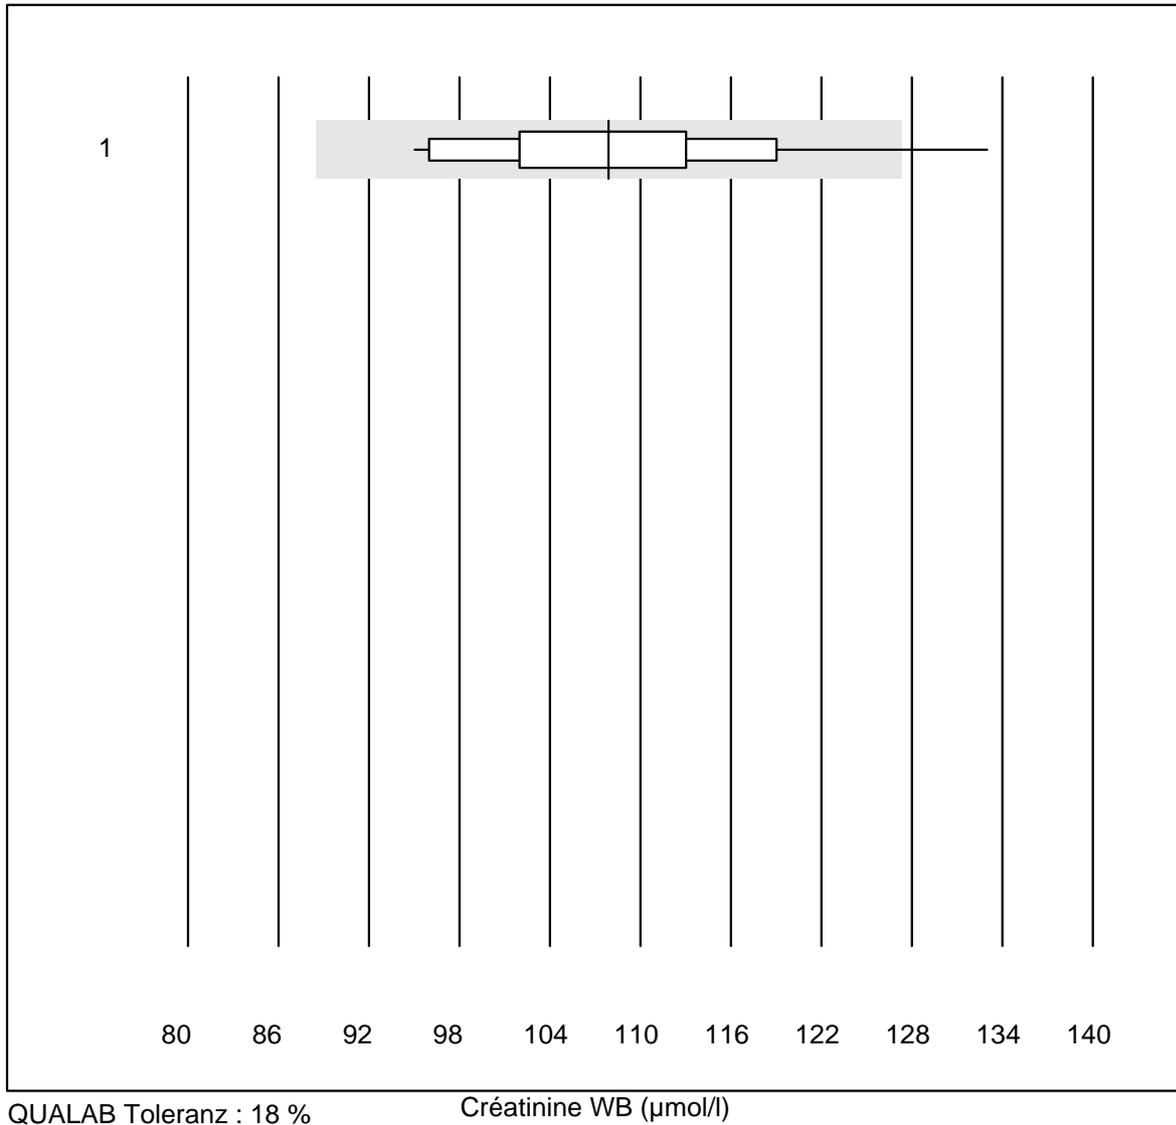

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Statsensor i / Nova	33	87.9	3.0	9.1	108	8.8	e

Amylase-urine

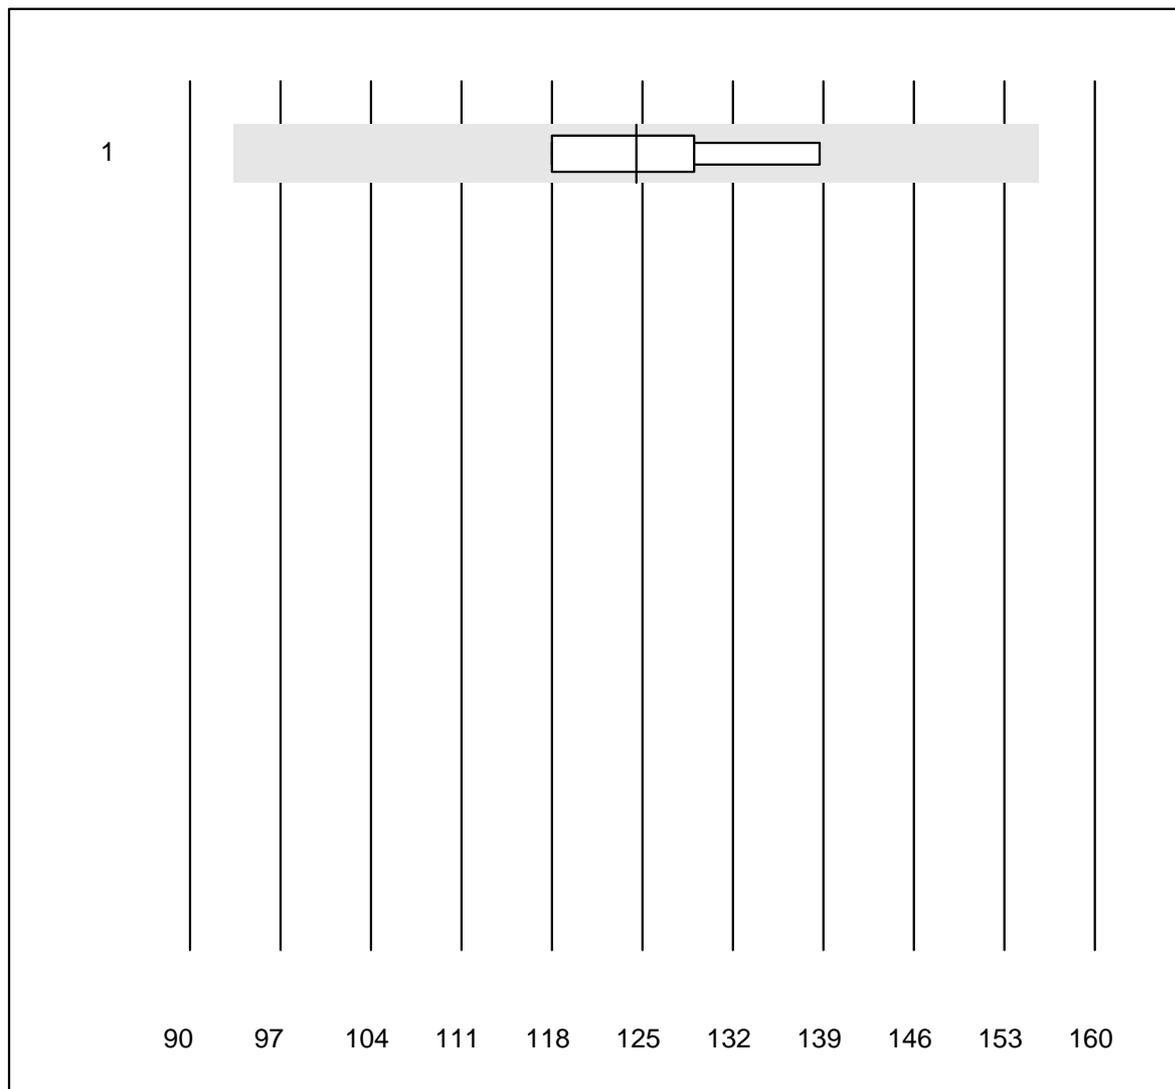


Tolérance MQ : 25 %

Amylase-urine (U/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	4	100.0	0.0	0.0	125	7.5	e*

Panc. Amylase-urine

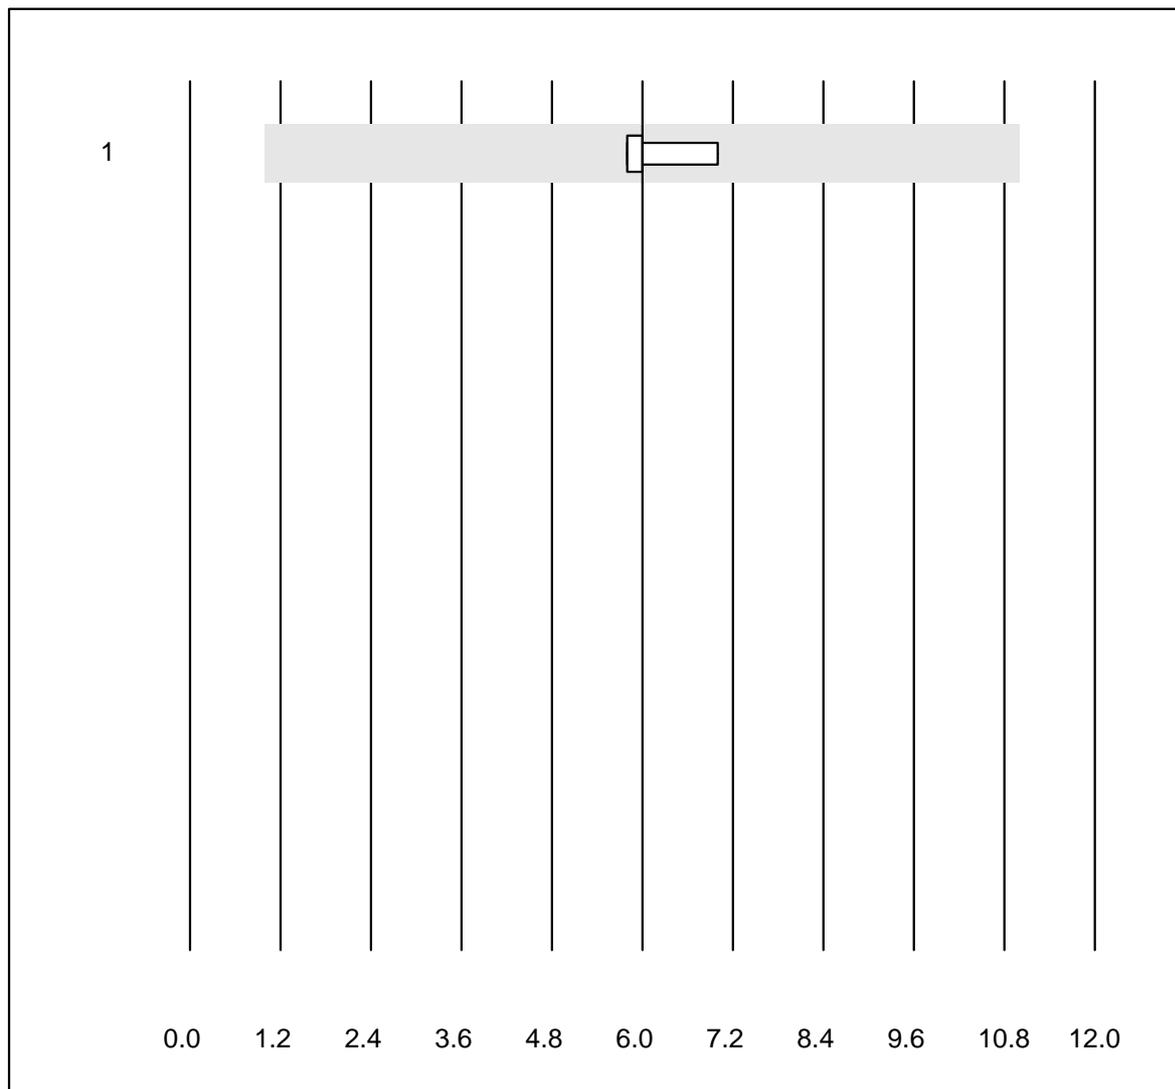


QUALAB Toleranz : 18 %
(< 25.0: +/- 5.0 U/l)

Panc. Amylase-urine (U/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	4	100.0	0.0	0.0	6.0	8.7	e*

Calcium-urine

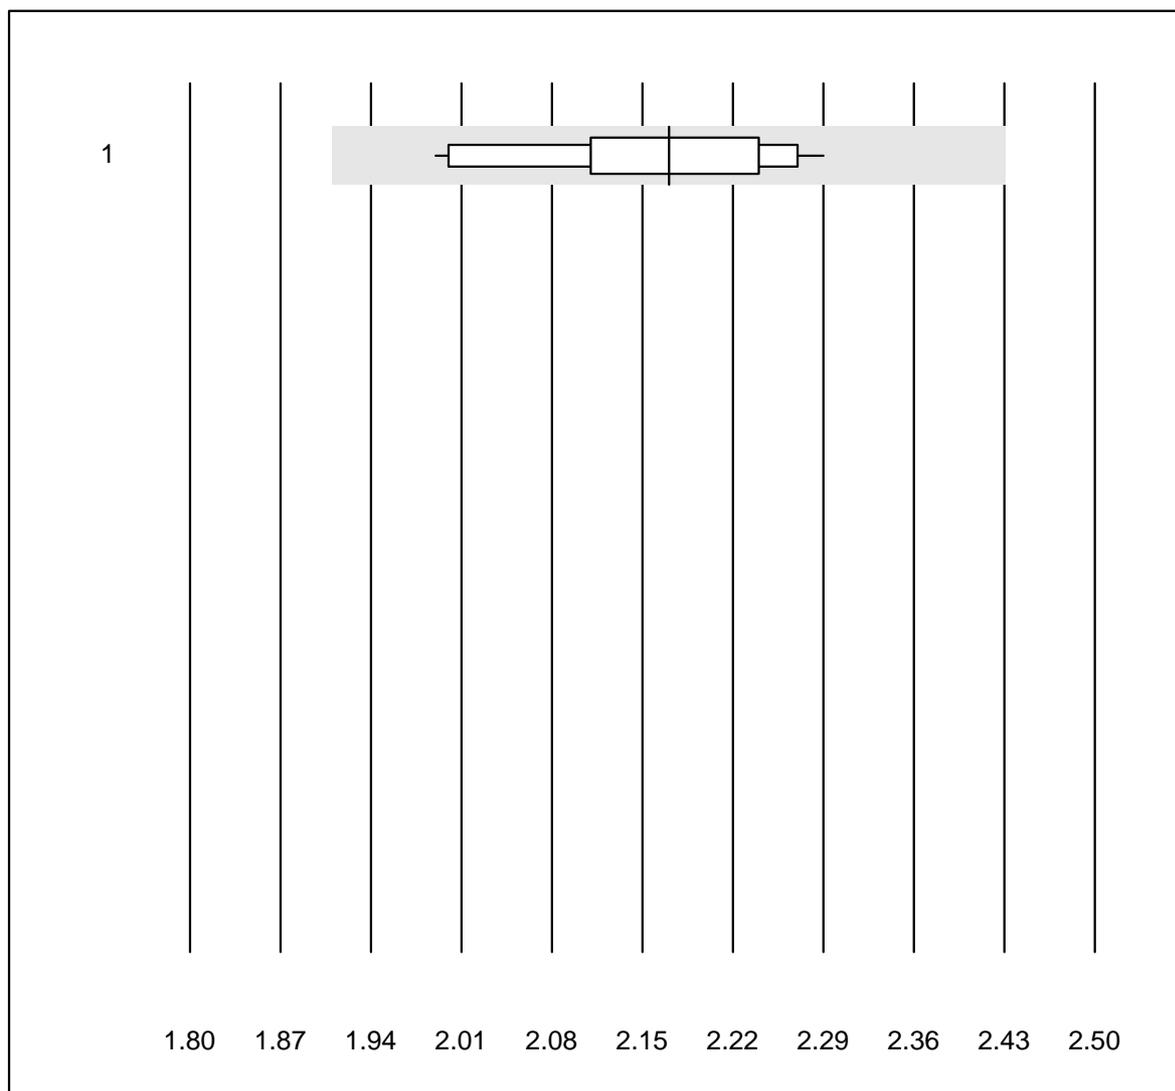


Tolérance MQ : 12 %

Calcium-urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Efulft	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	16	100.0	0.0	0.0	2.17	4.2	e

Chlorures-urine

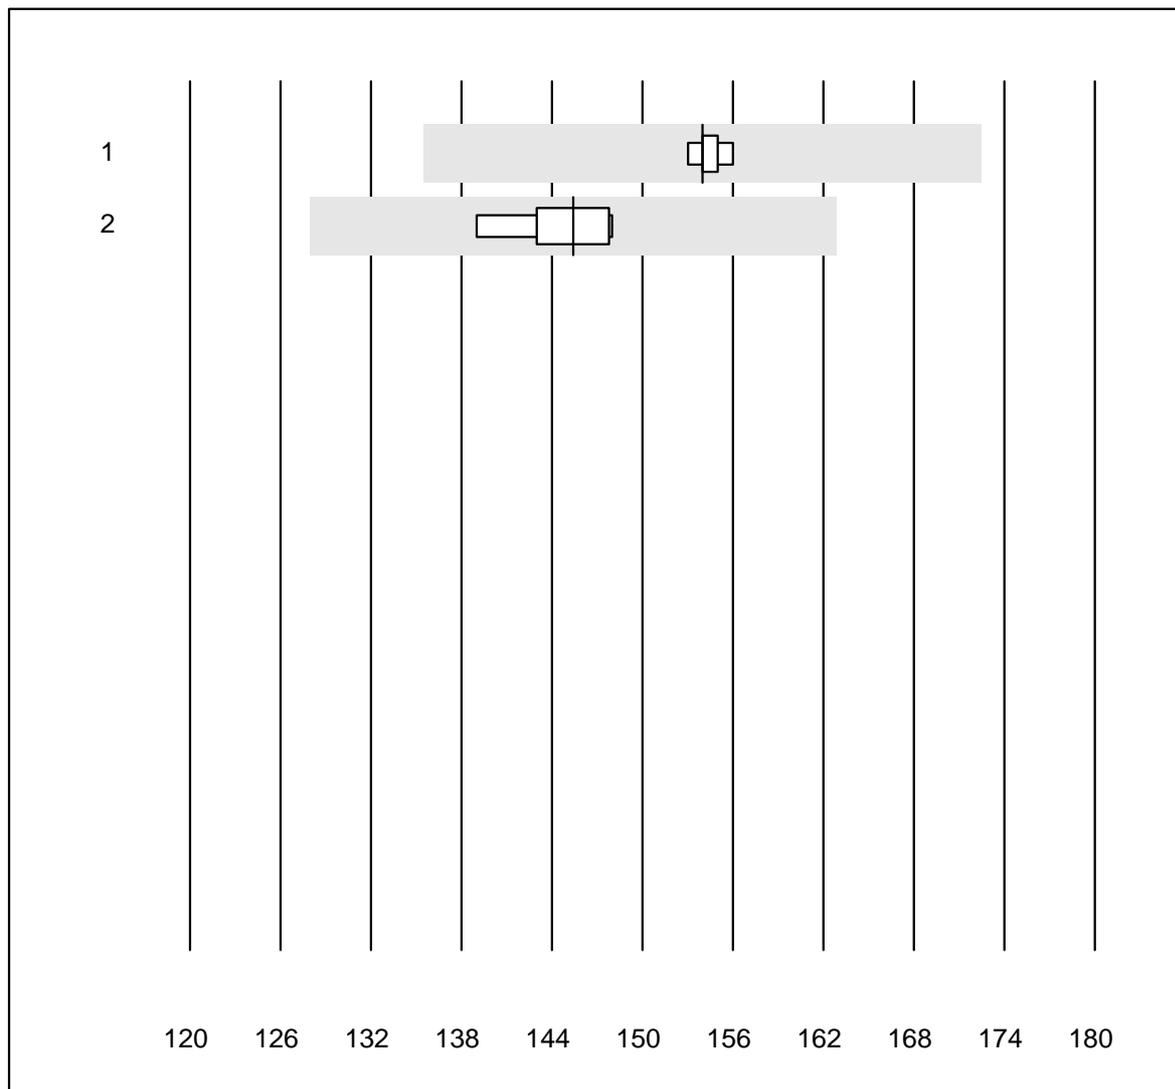


Tolérance MQ : 12 %

Chlorures-urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Efulft	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	7	100.0	0.0	0.0	154	0.6	e
2	Cobas	6	100.0	0.0	0.0	145	2.4	e

Glucose-urine

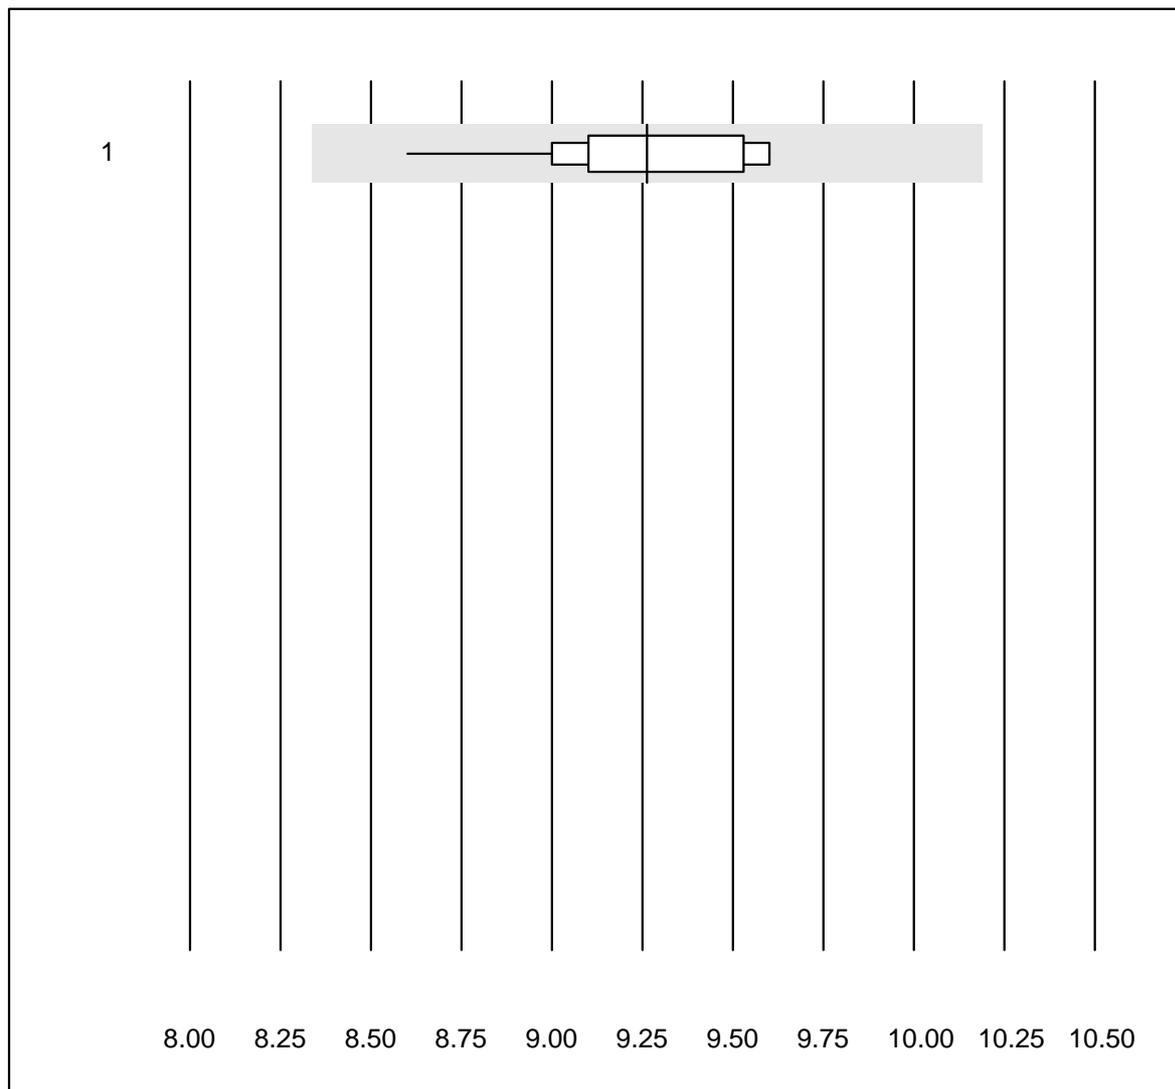


Tolérance MQ : 10 %

Glucose-urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	19	94.7	0.0	5.3	9.3	2.9	e

Magnésium-urine

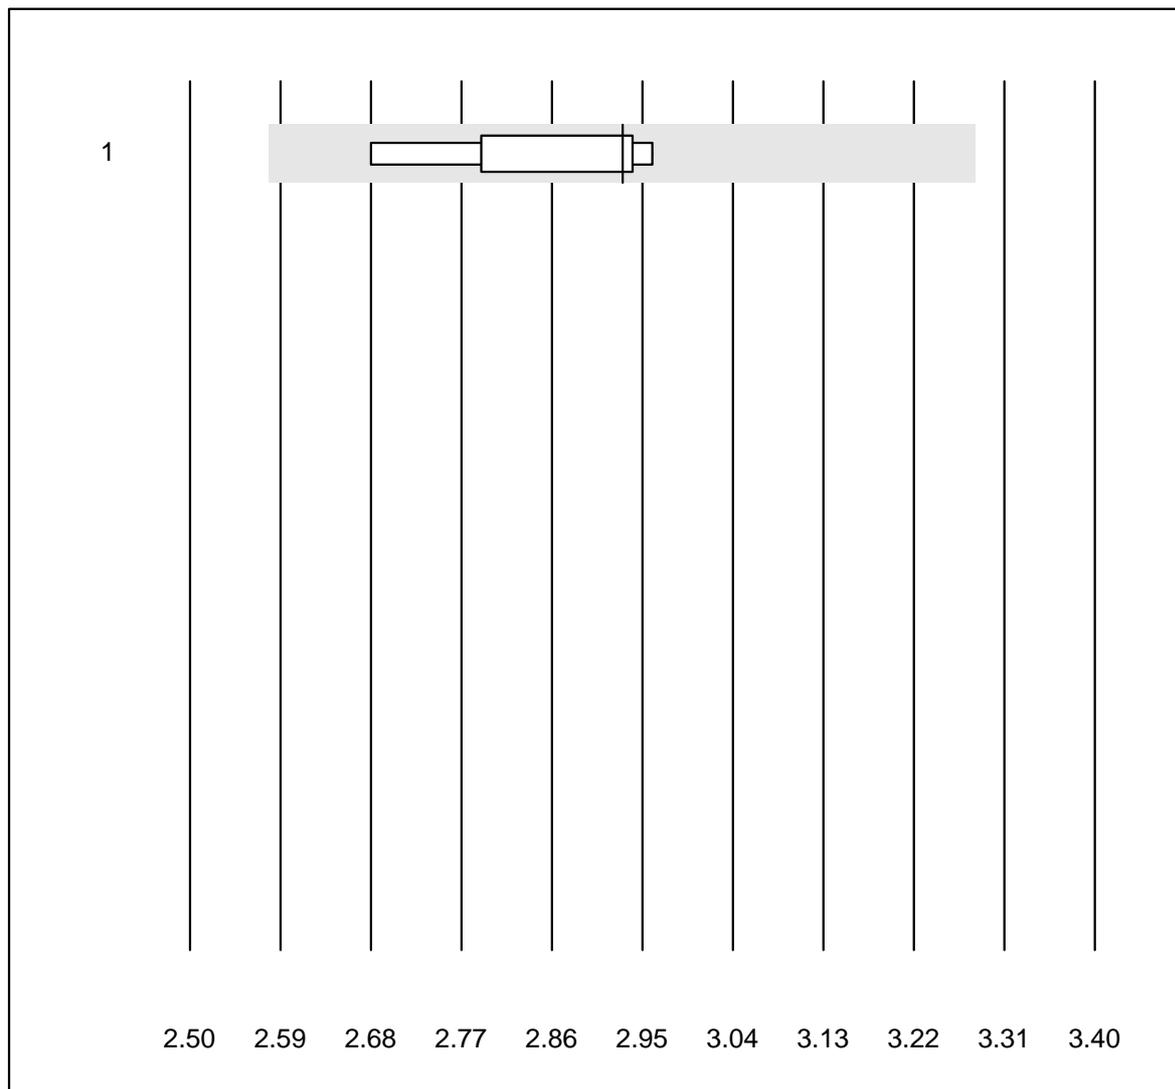


Tolérance MQ : 12 %

Magnésium-urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	8	100.0	0.0	0.0	2.93	3.4	e

Osmolalité-urine

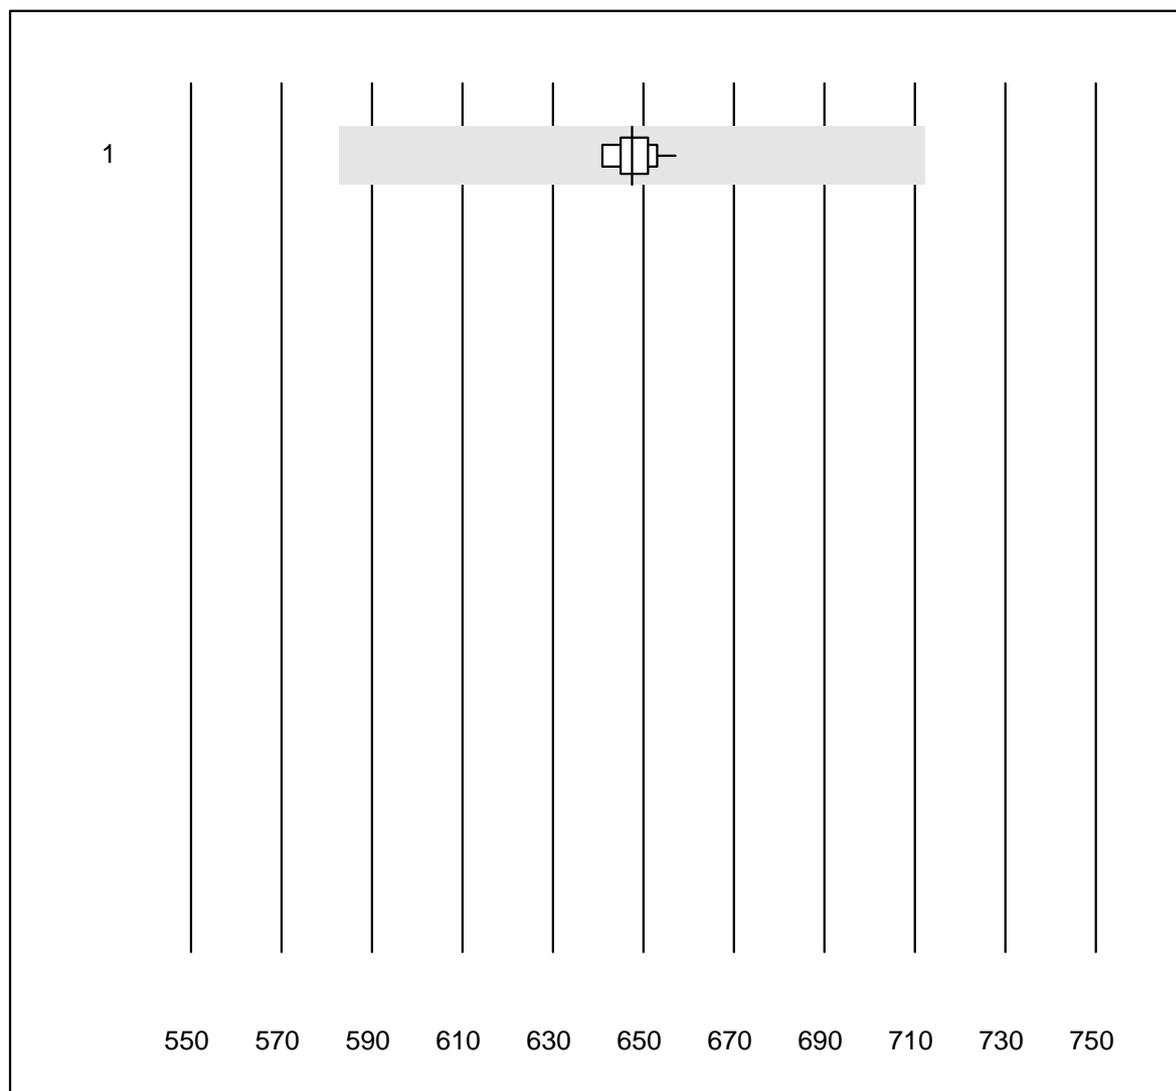


Tolérance MQ : 10 %

Osmolalité-urine (mosm/kg)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cryoscopie	10	100.0	0.0	0.0	648	0.8	e

Phosphore-urine

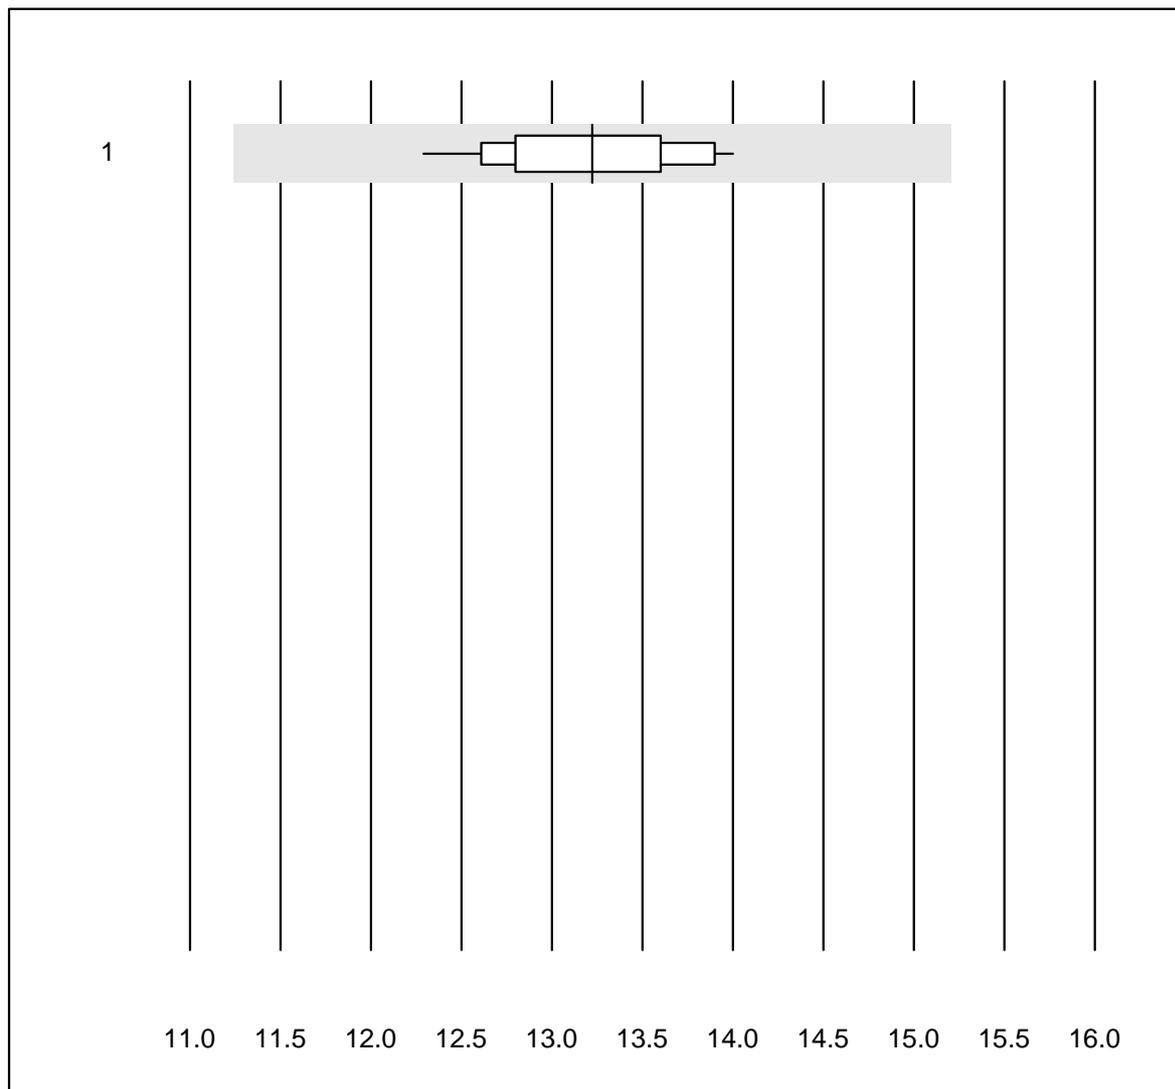


Tolérance MQ : 15 %

Phosphore-urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Efulft	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	15	100.0	0.0	0.0	13.2	3.8	e

Potassium-urine

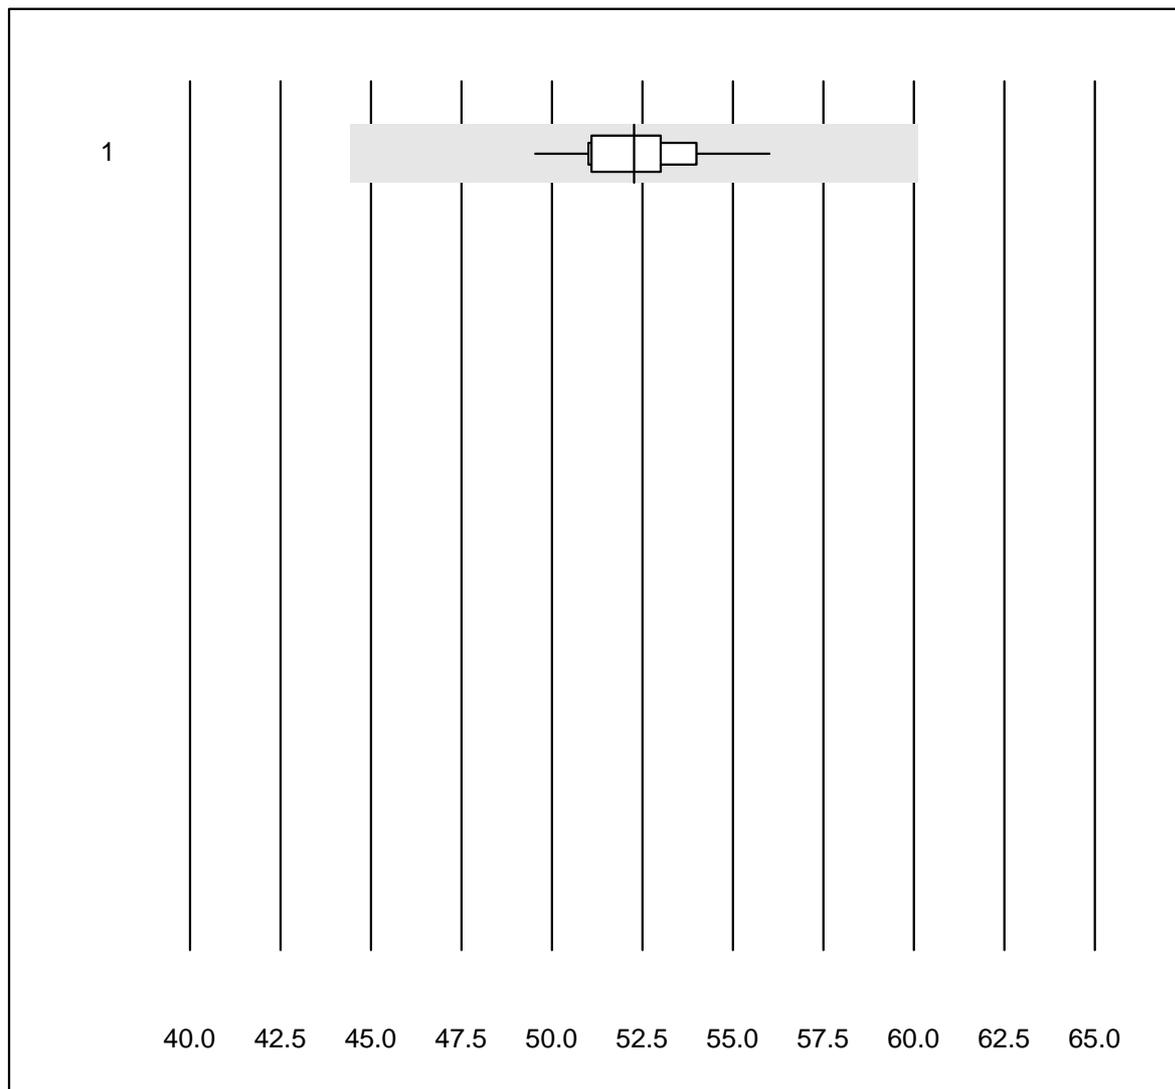


Tolérance MQ : 15 %

Potassium-urine (mmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	23	100.0	0.0	0.0	52	2.9	e

Protéines-urine

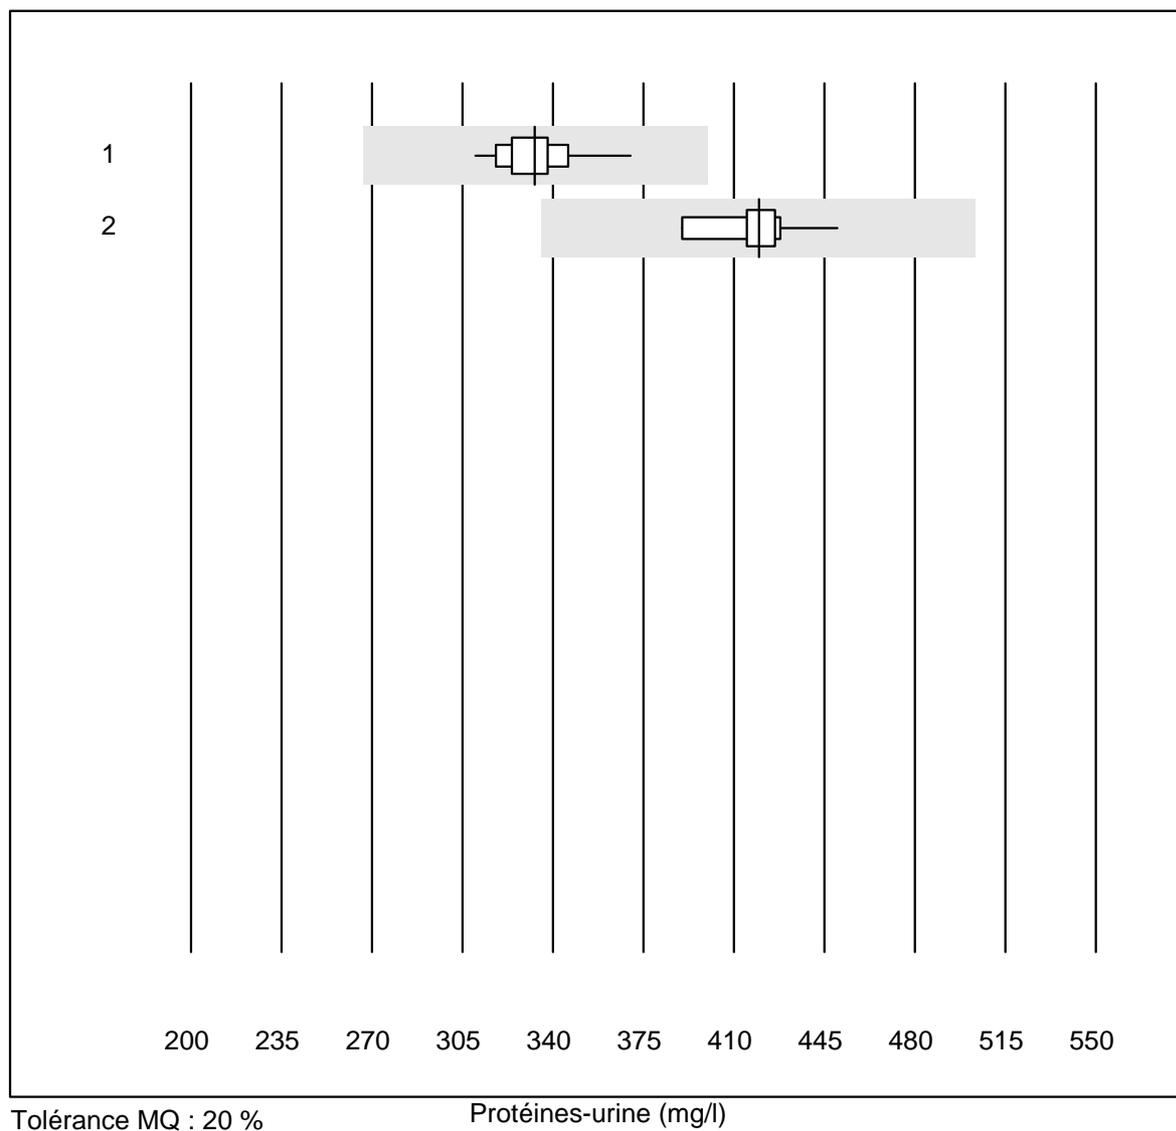

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas/Roche	12	100.0	0.0	0.0	333.1	4.5	e
2	Chimie humide	10	100.0	0.0	0.0	419.6	3.7	e

Sodium-urine

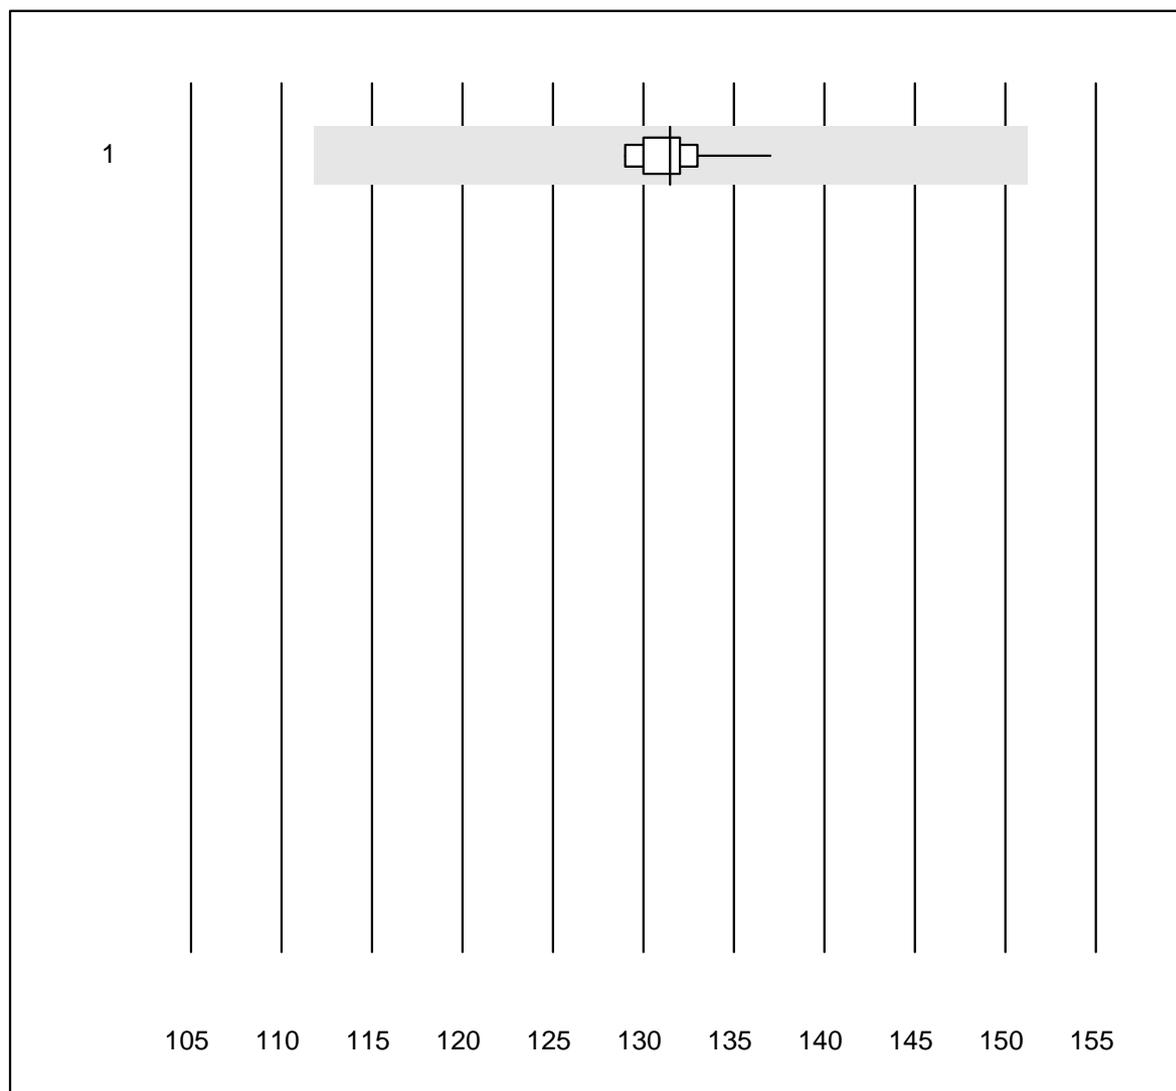


Tolérance MQ : 15 %

Sodium-urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	23	100.0	0.0	0.0	131	1.4	e

Urée-urine

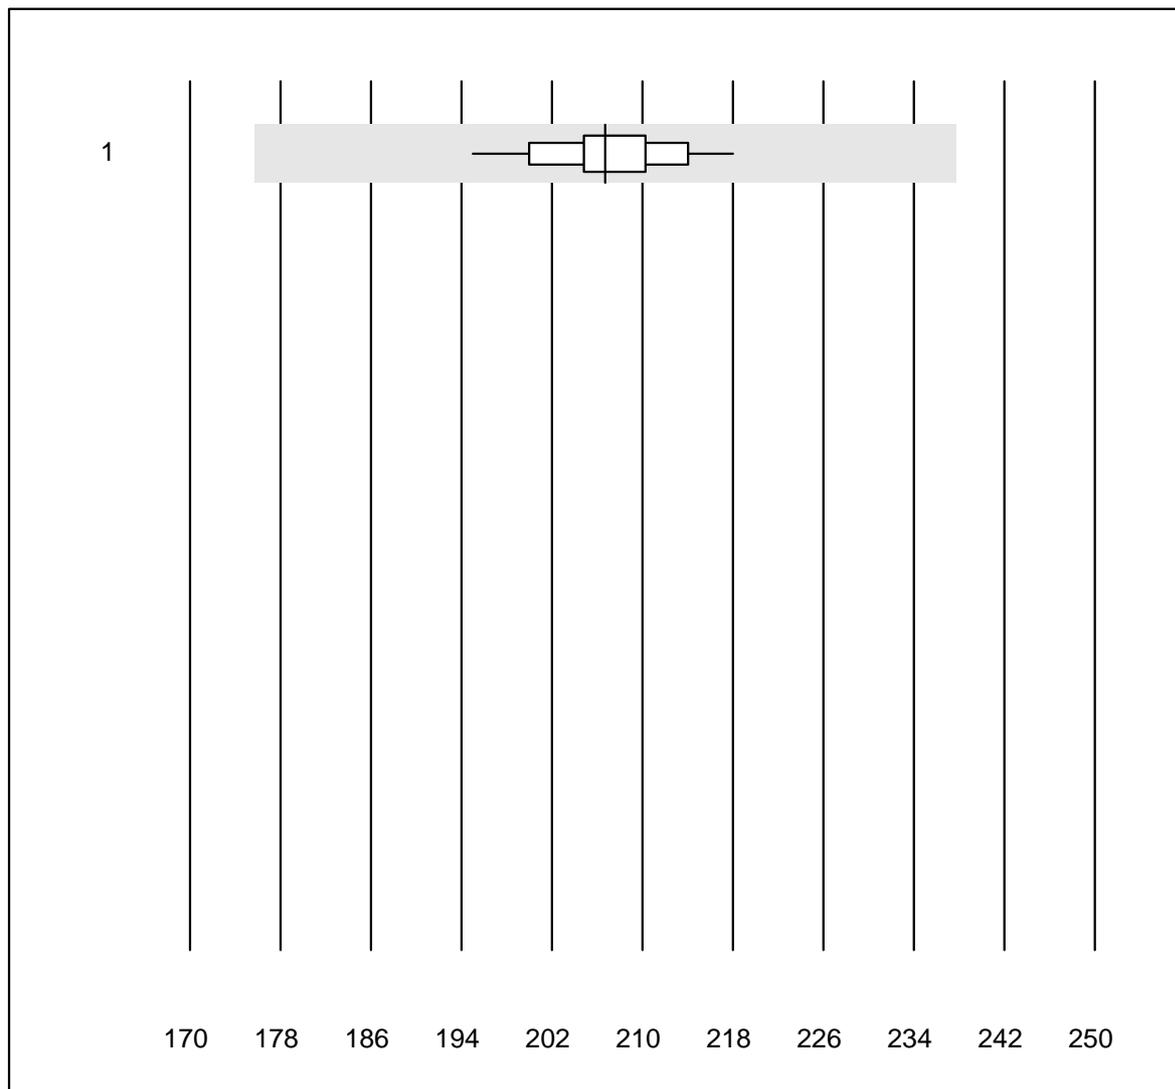


Tolérance MQ : 15 %

Urée-urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Efulft	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	18	100.0	0.0	0.0	207	2.6	e

Acide urique-urine

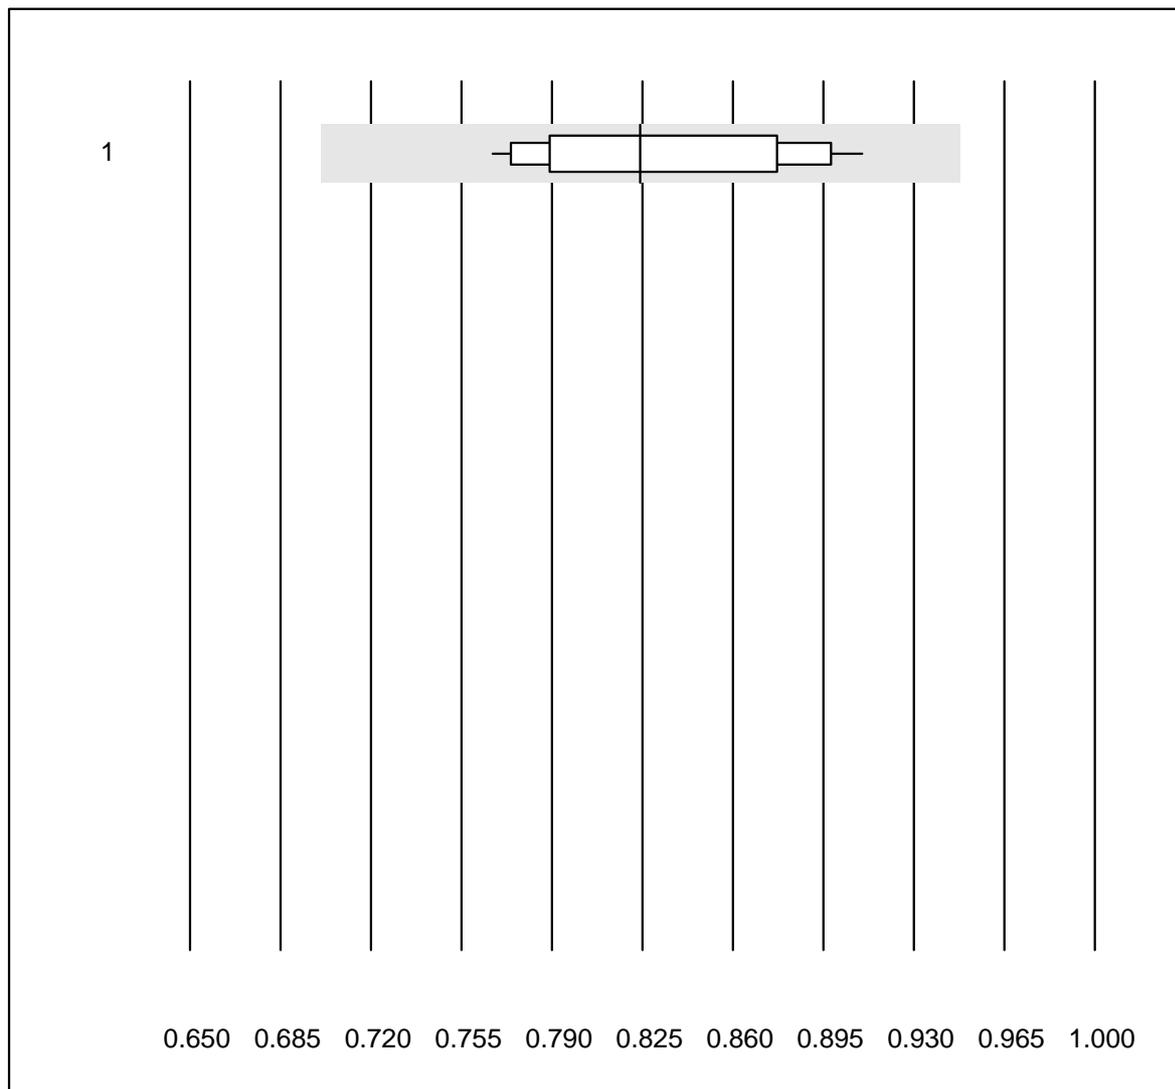


Tolérance MQ : 15 %

Acide urique-urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	14	100.0	0.0	0.0	0.82	6.0	e

Gravité spécifique-urine

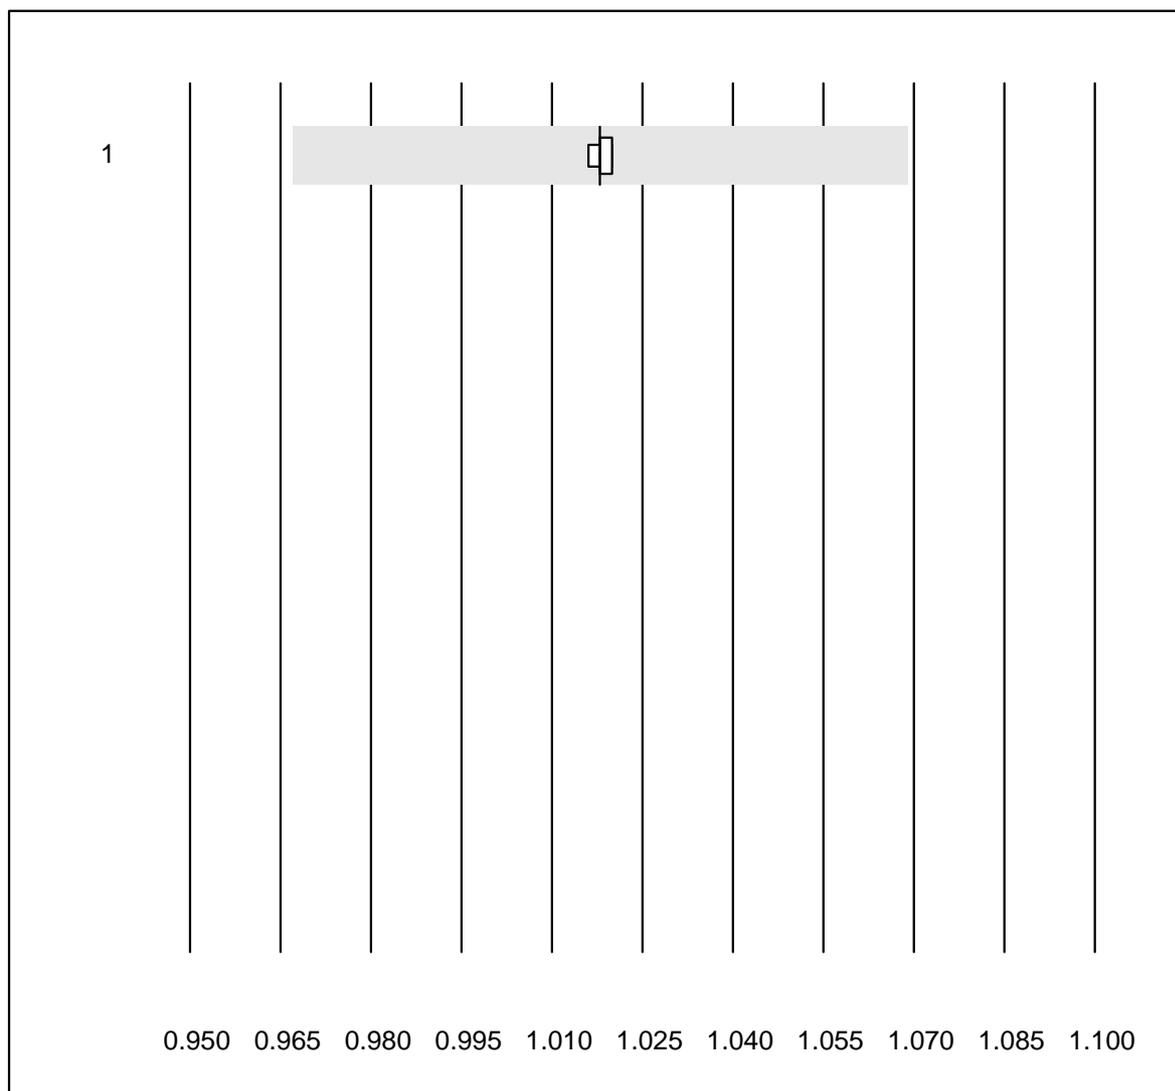


Tolérance MQ : 5 %

Gravité spécifique-urine ()

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Refraktometer	7	100.0	0.0	0.0	1.018	0.1	e

Microalbumine

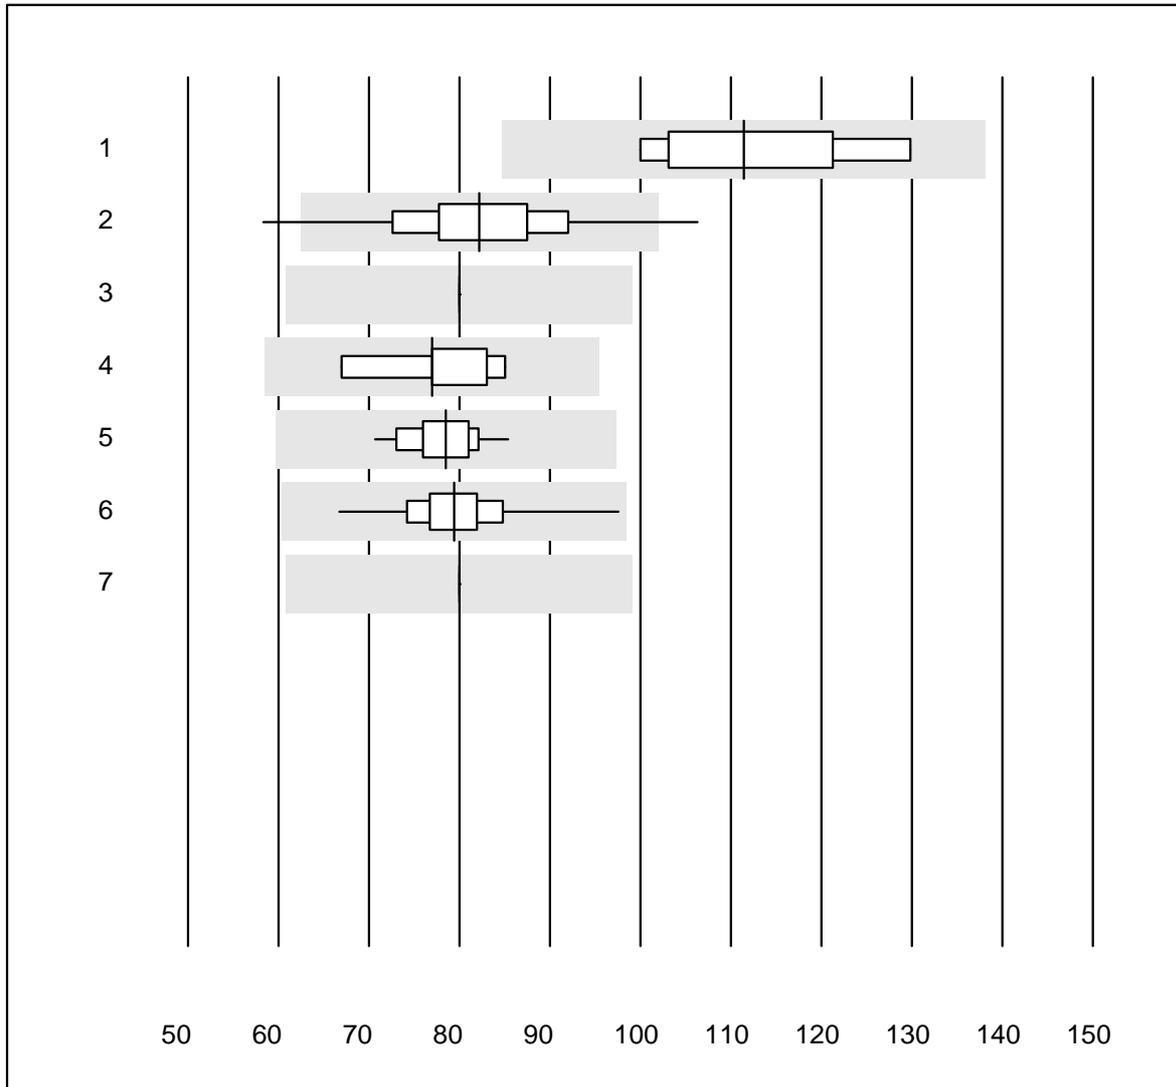


QUALAB Toleranz : 24 %

Microalbumine (mg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	AFIAS	7	100.0	0.0	0.0	111.4	9.0	e*
2	Afinion	424	97.7	0.9	1.4	82.2	9.3	e
3	Sysmex U	18	66.7	0.0	33.3	80.0	0.0	e
4	NycoCard	5	100.0	0.0	0.0	77.0	9.0	e*
5	Turbidimetrie	22	100.0	0.0	0.0	78.5	5.1	e
6	DCA2000/Vantage	138	97.8	0.0	2.2	79.4	5.8	e
7	Siemens Clinitek	13	76.9	0.0	23.1	80.0	0.0	e

Créatinine urine

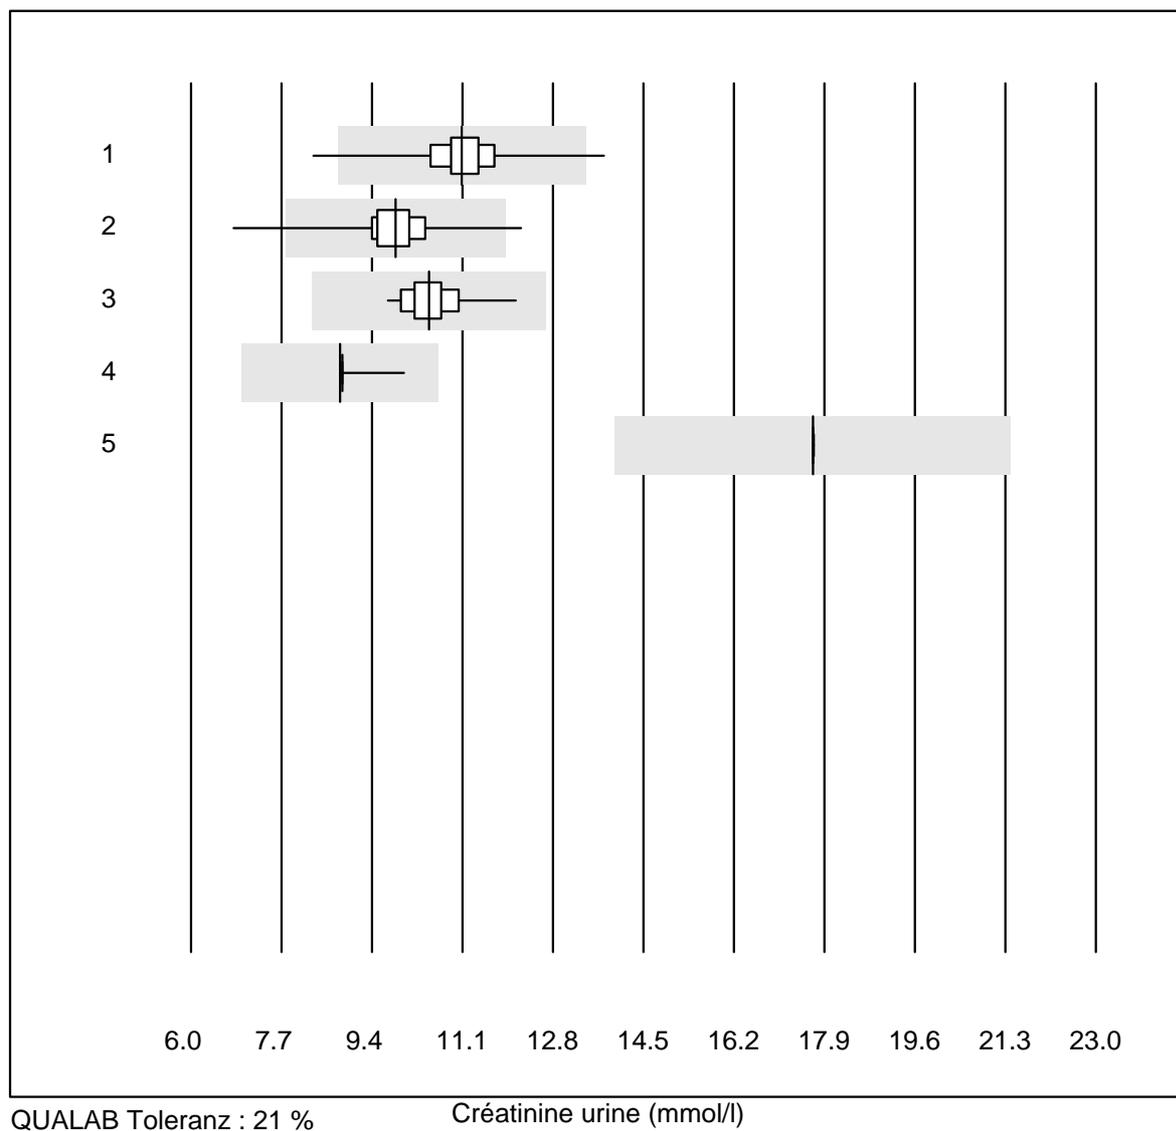

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	DCA2000/Vantage	137	95.6	1.5	2.9	11.1	5.2	e
2	Afinion	424	98.1	0.7	1.2	9.8	5.0	e
3	Chimie humide	37	100.0	0.0	0.0	10.5	4.5	e
4	Sysmex U	18	72.2	0.0	27.8	8.8	3.6	a
5	Siemens Clinitek	11	72.7	0.0	27.3	17.7	0.1	e