

Verein für  
Association pour le  
Associazione per il



medizinische Qualitätskontrolle  
contrôle de qualité médical  
controllo di qualità medico

# **Commentaire de l'essai interlaboratoire**

## **2020 - 3**

### Échantillons de l'essai interlaboratoire

L'homogénéité et la stabilité ont été vérifiées pour tous les échantillons avant respectivement pendant l'envoi et aucune anomalie n'a été constatée. Les tests de conformité ont été réalisés par les laboratoires de l'Hôpital Universitaire de Zürich (<http://www.uzl.usz.ch/>).

Ont été produits spécifiquement pour MQ en sous-traitance les échantillons d'essai interlaboratoire suivants:

B1 Strep A Test, B2 Uricult, H4 Hématologie parasitaire, K14 Marqueur tumoral

### Détermination des valeurs-cible

Pour chaque valeur-cible est indiqué le mode de détermination utilisé selon les termes de la norme ISO17043:2010, B2.1 (Colonne "Type"):

- a Valeur connue, sur la base de la production.
- b Valeur de référence certifiée lors de l'utilisation d'échantillons spécifiques
- c Valeur de référence déterminée par analyse
- d „Consensus value“ des laboratoires d'experts
- e „Consensus value“ des participants

Pour les groupes de méthode incluant plus de 9 participants, les valeurs cibles sont déterminées comme étant la „Consensus value“ ("e") des participants. Pour la détermination de ces valeurs cibles est utilisée la moyenne réalisée par le groupe de méthodes. Les résultats qui présentent un écart par rapport à la valeur cible supérieur à 1.5 fois la tolérance Qualab, sont considérés comme résultats aberrants et exclus du calcul de la valeur de référence. Les résultats des essais d'aptitude sont utilisés comme valeur de base pour éliminer les taux aberrants. Afin de mettre à disposition de tous les participants des valeurs-cible les plus pertinentes possibles, d'autres procédures peuvent également être utilisées pour des groupes de méthode plus restreints.

### Incertitude dans la détermination des valeurs-cible

L'incertitude-type ( $u_x$ ) est calculée à l'aide de la formule suivante (ISO13528):

$$u_x = (\text{Valeur-cible}/100) * (1.25/\text{Racine carrée du "nombre des participants"}) * \text{CV en \%}$$

- $u_x$  est exprimée dans la même unité que la valeur-cible
- $u_x$  peut être comparée avec l'écart-type du collectif des participants ( $\text{Ecart-type} = \text{Valeur-cible} * \text{CV en \%} / 100$ )
- Pour un nombre de participants >18, l'incertitude-type ( $u_x$ ) est significativement plus petite que la dispersion du collectif des participants et peut donc être négligée.


### Tolérances QUALAB et MQ

Pour les analyses obligatoires sont utilisées les tolérances fixées par Qualab ([www.qualab.ch](http://www.qualab.ch), contrôle de qualité externe). Pour les analyses non-obligatoires, les tolérances sont fixées par le directeur de MQ pilotant l'essai interlaboratoire.

Si l'incertitude déterminée de la valeur de référence  $u_x$  est supérieure à 15% de la tolérance QUALAB ou de MQ, la lettre qui caractérise le type de détermination de la valeur-cible est en outre marquée d'une étoile (par exemple "e\*"). Nous rendons ainsi les participants attentifs au fait que l'incertitude de la valeur de référence peut avoir une influence sur l'évaluation.

### Représentation graphique

La représentation graphique des résultats est la suivante:

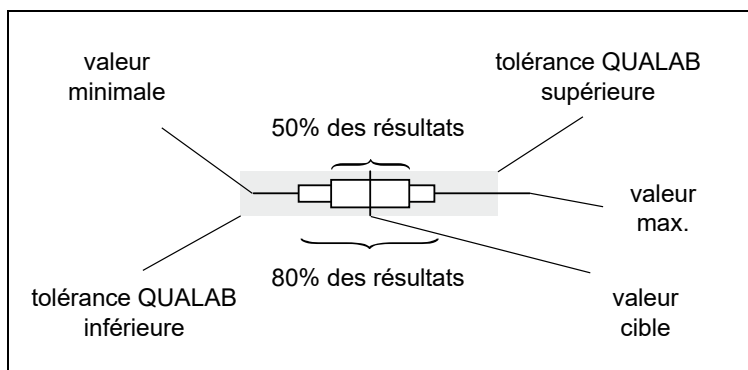


### **Comparaison des appareils**

Les données de ce rapport vous permettent de comparer les performances respectives des divers appareils. Toutefois, vous devez tenir compte des points suivants:

- Le contrôle Chimie K1 est un sérum de contrôle commercialisé prêt à l'emploi. Même si l'échantillon est d'origine humaine, des effets matriciels sont possibles. Ceux-ci dépendent de l'appareil et peuvent générer des valeurs cible différentes.
- Seul un échantillon a été mesuré. La dispersion des résultats étant dépendante de la nature de l'échantillon (effets matriciels) et du niveau du résultat, les coefficients de variation déterminés (CV en %) ne sont pas toujours valables.
- Une grande partie des taux aberrants est due à des erreurs administratives (erreur d'unité, confusion des résultats) ou à des erreurs de manipulation (erreur d'échantillon, dissolution incorrecte, mélange insuffisant) et n'a rien à voir avec le type d'appareil.


Zürich, 30.9.2020



Dr. R. Fried  
Directeur de l'essai interlaboratoire

*Il n'est pas autorisé de publier une partie ou l'intégralité de ce rapport sans notre accord écrit préalable. L'original est conservé dans les archives sous [www.mqzh.ch](http://www.mqzh.ch).*

## Quick OA

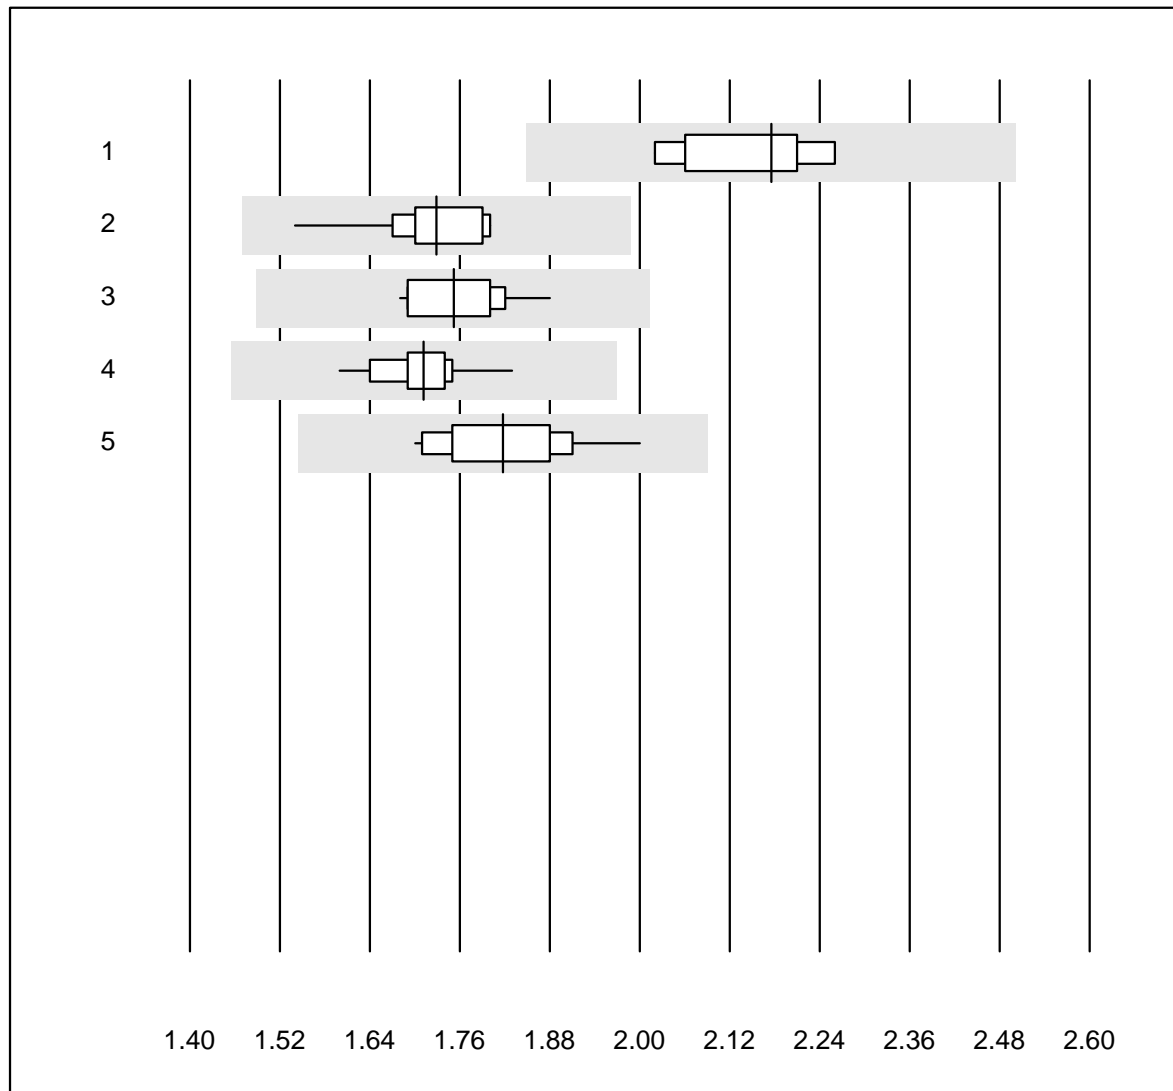


QUALAB Toleranz : 15 %

Quick OA ()


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Neoplastin Plus	6	100.0	0.0	0.0	2.18	4.3	e
2 Innovin	13	100.0	0.0	0.0	1.73	4.3	e
3 Recombiplastin 2G	11	100.0	0.0	0.0	1.75	3.6	e
4 Autres méthodes	12	100.0	0.0	0.0	1.71	3.4	e
5 Neoplastin R	11	100.0	0.0	0.0	1.82	5.0	e

## Fibrinogène OA

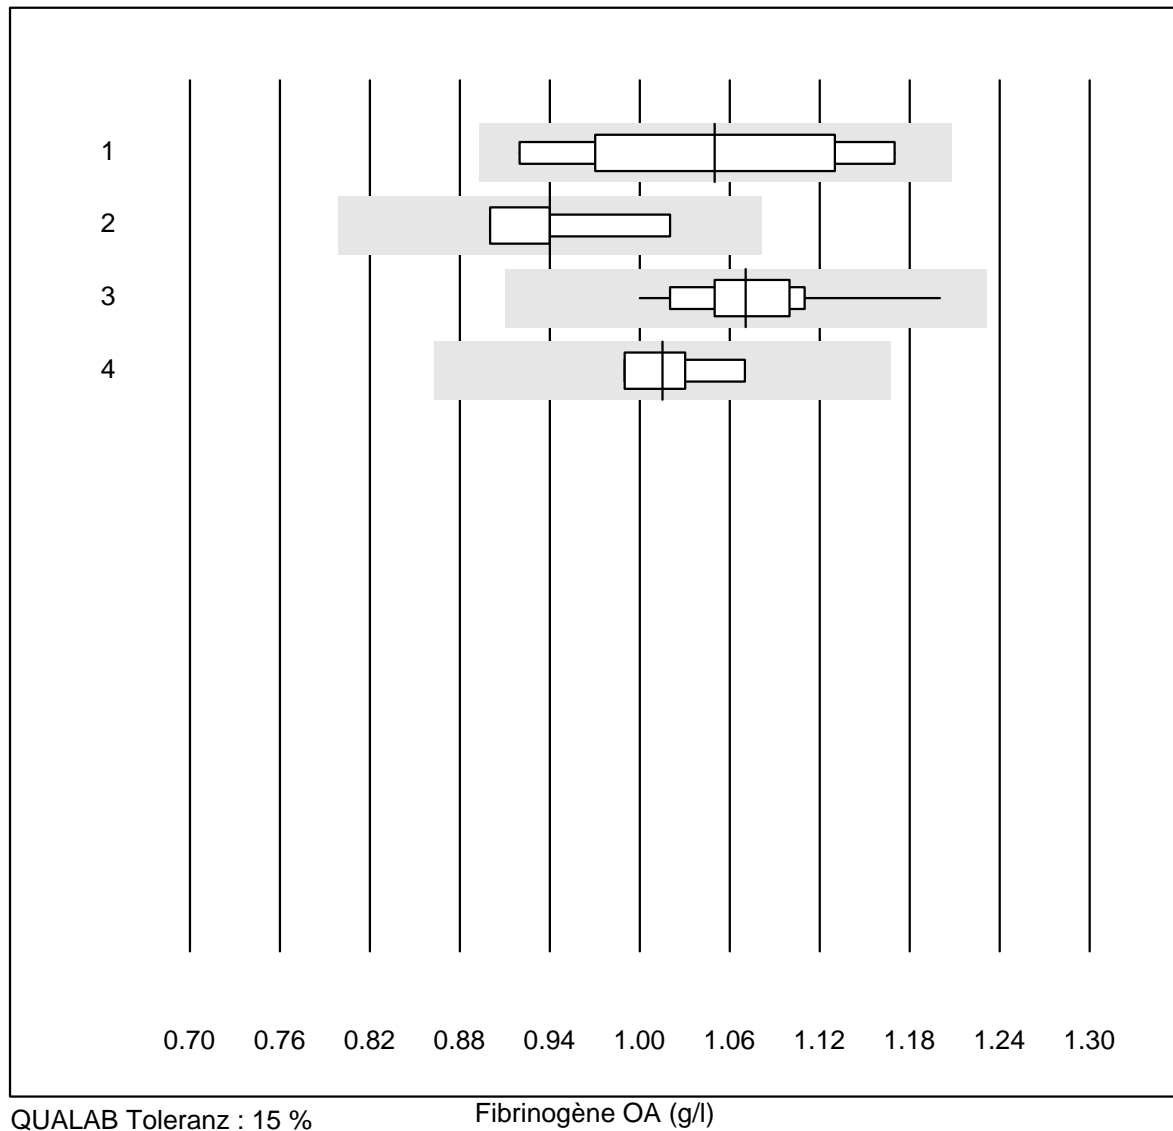

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Autres méthodes	7	100.0	0.0	0.0	1.05	8.8	e*
2	Siemens Thrombin	5	80.0	0.0	20.0	0.94	5.3	e*
3	Stago/STA	13	100.0	0.0	0.0	1.07	4.7	e
4	Fibrinogen Q.F.A.	4	100.0	0.0	0.0	1.02	3.5	e

## aPTT OA

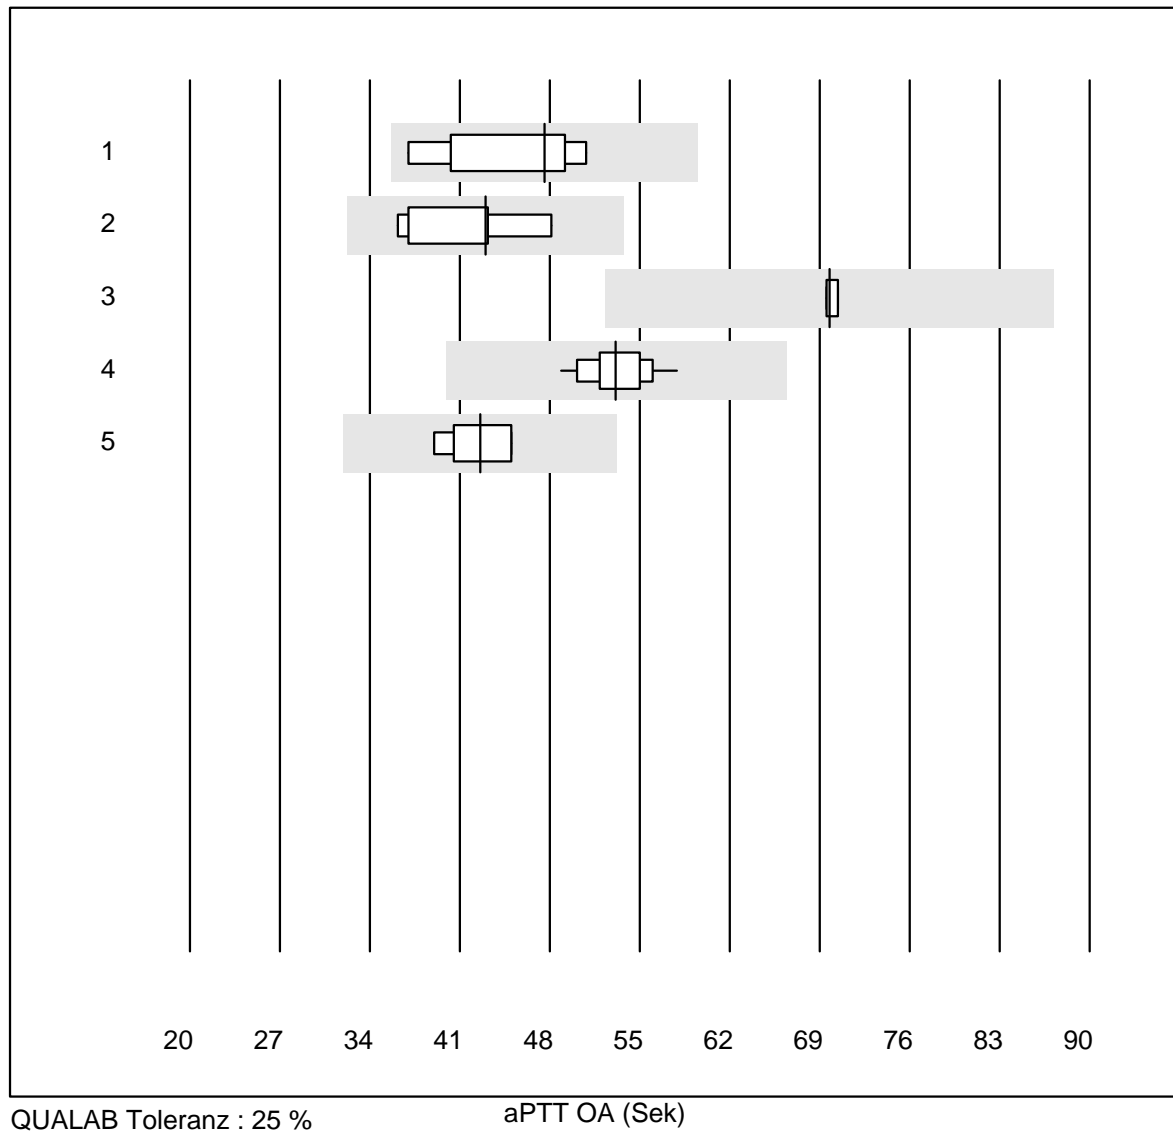


QUALAB Toleranz : 25 %

aPTT OA (Sek)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Autres méthodes	8	100.0	0.0	0.0	47.6	11.0	e*
2 Actin FS	8	100.0	0.0	0.0	43.0	9.3	e*
3 Pathromtin SL	4	75.0	0.0	25.0	69.8	0.6	e
4 Stago/STA	13	100.0	0.0	0.0	53.1	4.8	e
5 aPTT-SP	6	100.0	0.0	0.0	42.6	5.7	e

# INR CoaguChek

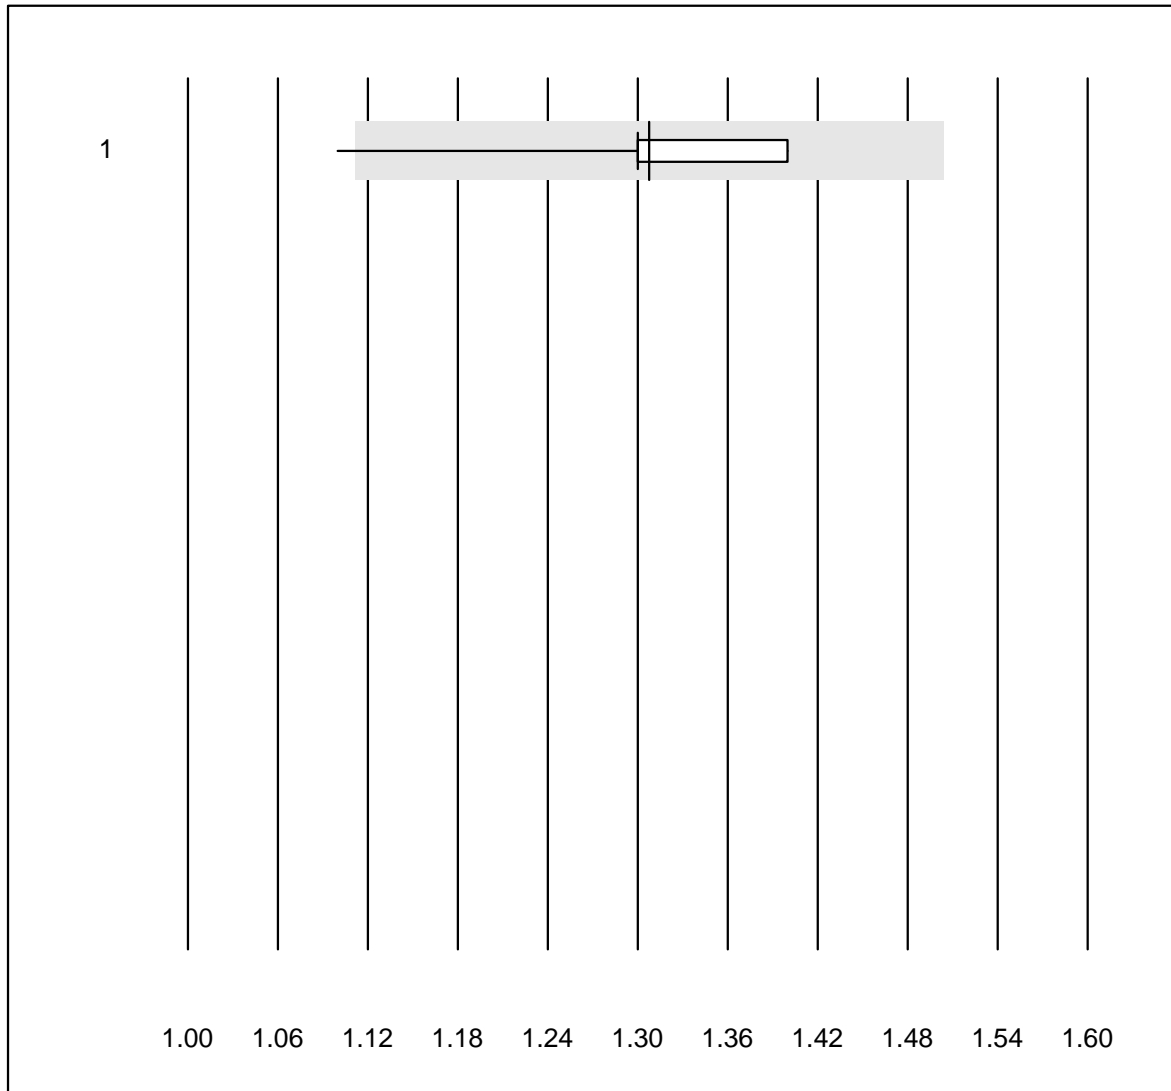

QUALAB Toleranz : 15 %

INR CoaguChek ()

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	CoaguChek Pro II	566	99.6	0.2	0.2	1.3	2.9	e

## Quick N




QUALAB Toleranz : 15 %

Quick N (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Neoplastin R	14	100.0	0.0	0.0	87	5.4	e
2	Neoplastin Plus	7	100.0	0.0	0.0	88	7.6	e*
3	Innovin	8	100.0	0.0	0.0	95	4.1	e
4	toutes les méthodes	10	100.0	0.0	0.0	98	3.2	e
5	Recombiplastin 2G	7	100.0	0.0	0.0	100	0.4	e



## Faktor II

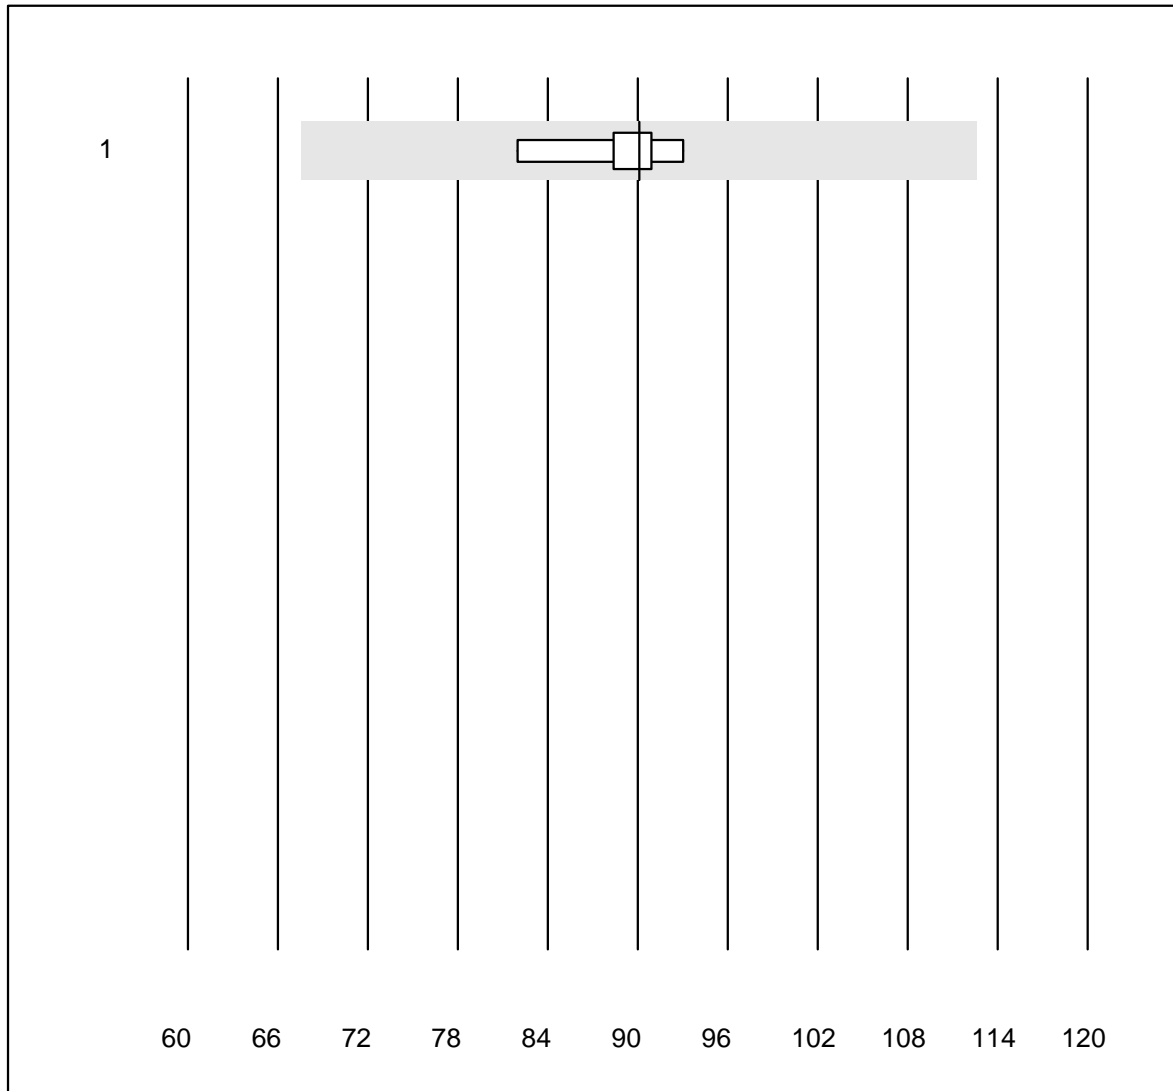


Tolérance MQ : 25 %

Faktor II (%)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	90.1	4.7	e

## Fibrinogen N

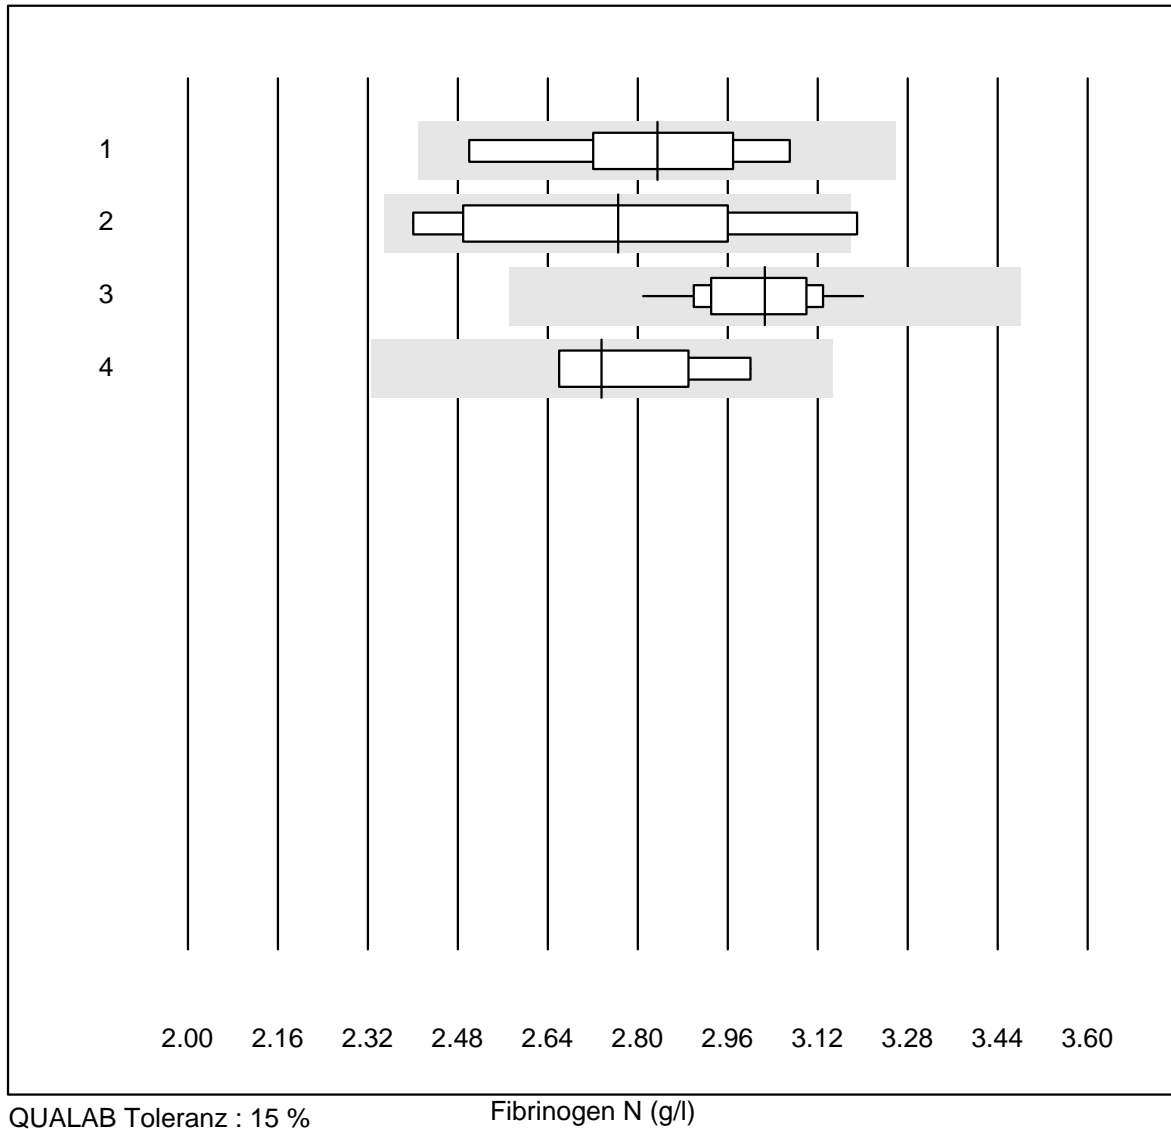

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Siemens Thrombin	6	100.0	0.0	0.0	2.84	7.1	e*
2 Autres méthodes	6	83.3	16.7	0.0	2.77	11.0	e*
3 Stago/STA	17	100.0	0.0	0.0	3.03	3.5	e
4 Fibrinogen Q.F.A.	6	100.0	0.0	0.0	2.74	5.0	e*

## Faktor V

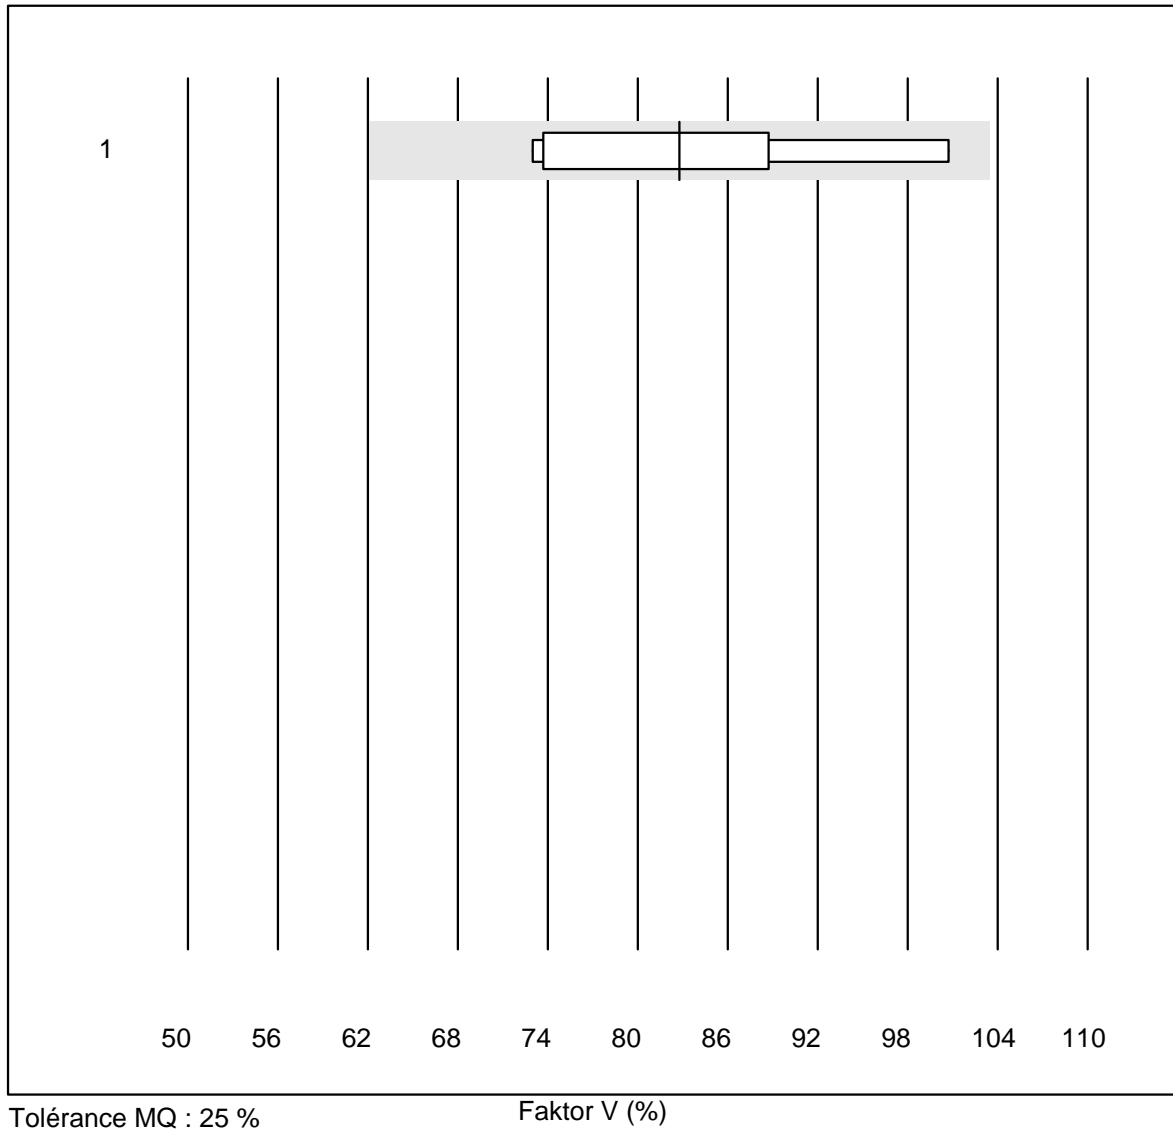


Tolérance MQ : 25 %

Faktor V (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	8	100.0	0.0	0.0	82.8	11.9	e*

## aPTT N

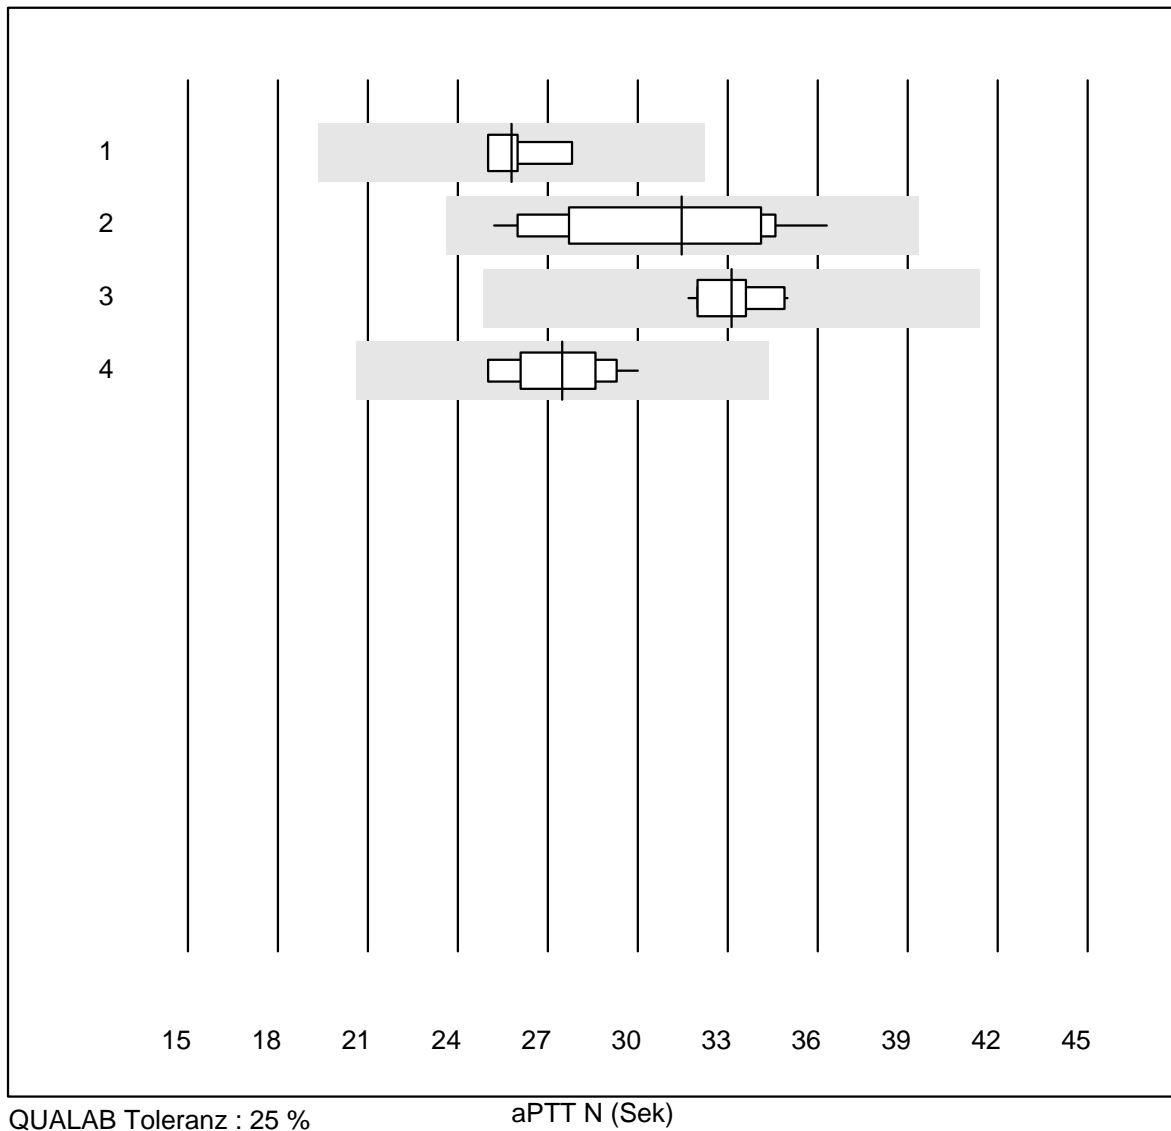


QUALAB Toleranz : 25 %

aPTT N (Sek)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Actin FS	4	100.0	0.0	0.0	25.8	4.6	e
2 Autres méthodes	11	100.0	0.0	0.0	31.5	12.2	e*
3 Stago/STA	16	100.0	0.0	0.0	33.1	3.0	e
4 aPTT-SP	10	100.0	0.0	0.0	27.5	6.0	e

## Faktor VII

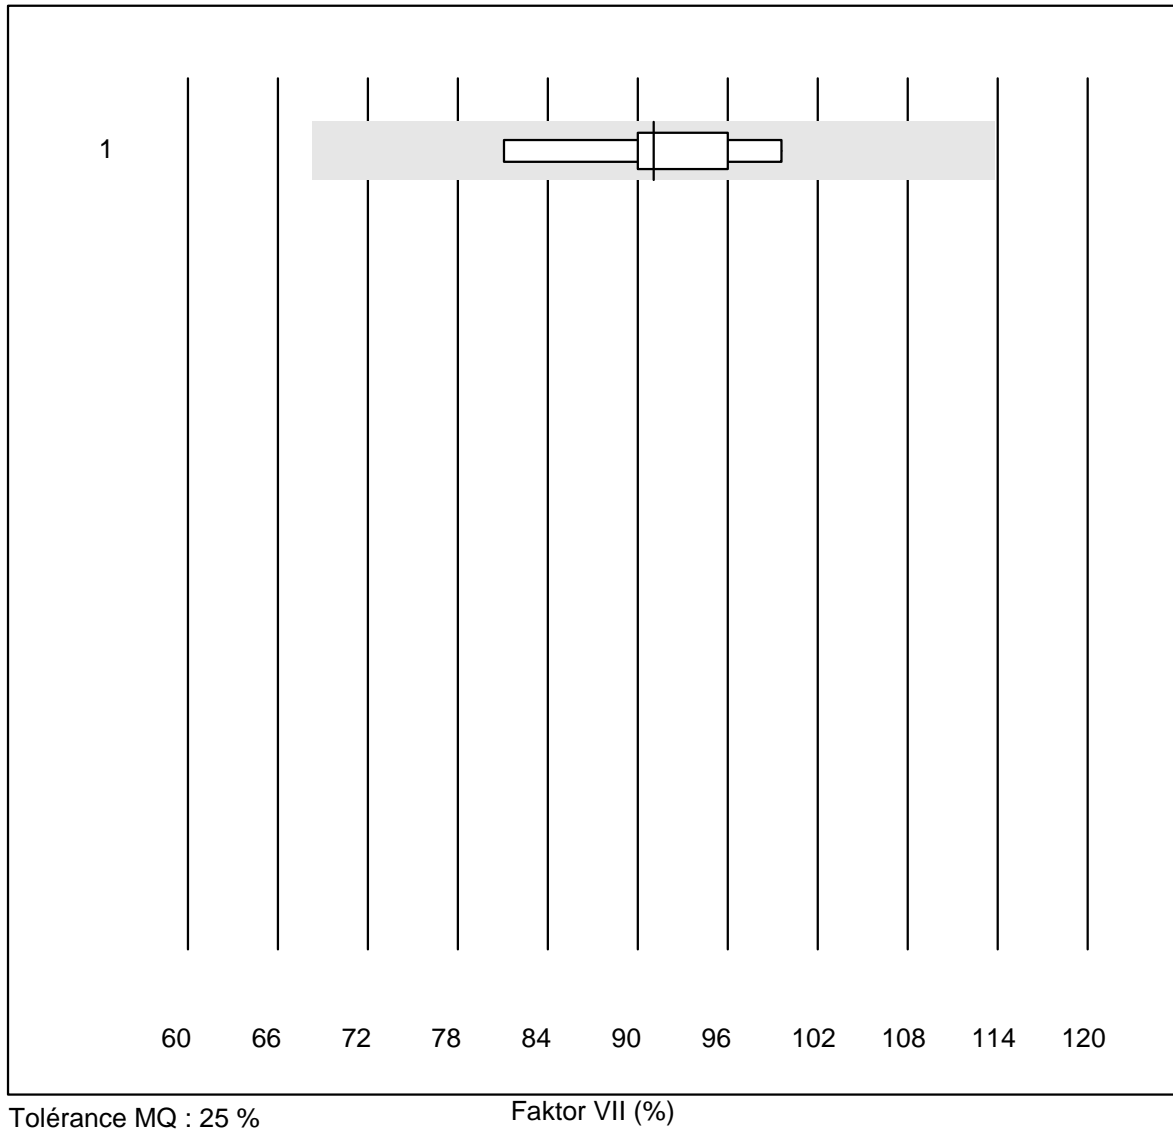


Tolérance MQ : 25 %

Faktor VII (%)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	91.1	6.9	e

## Quick H

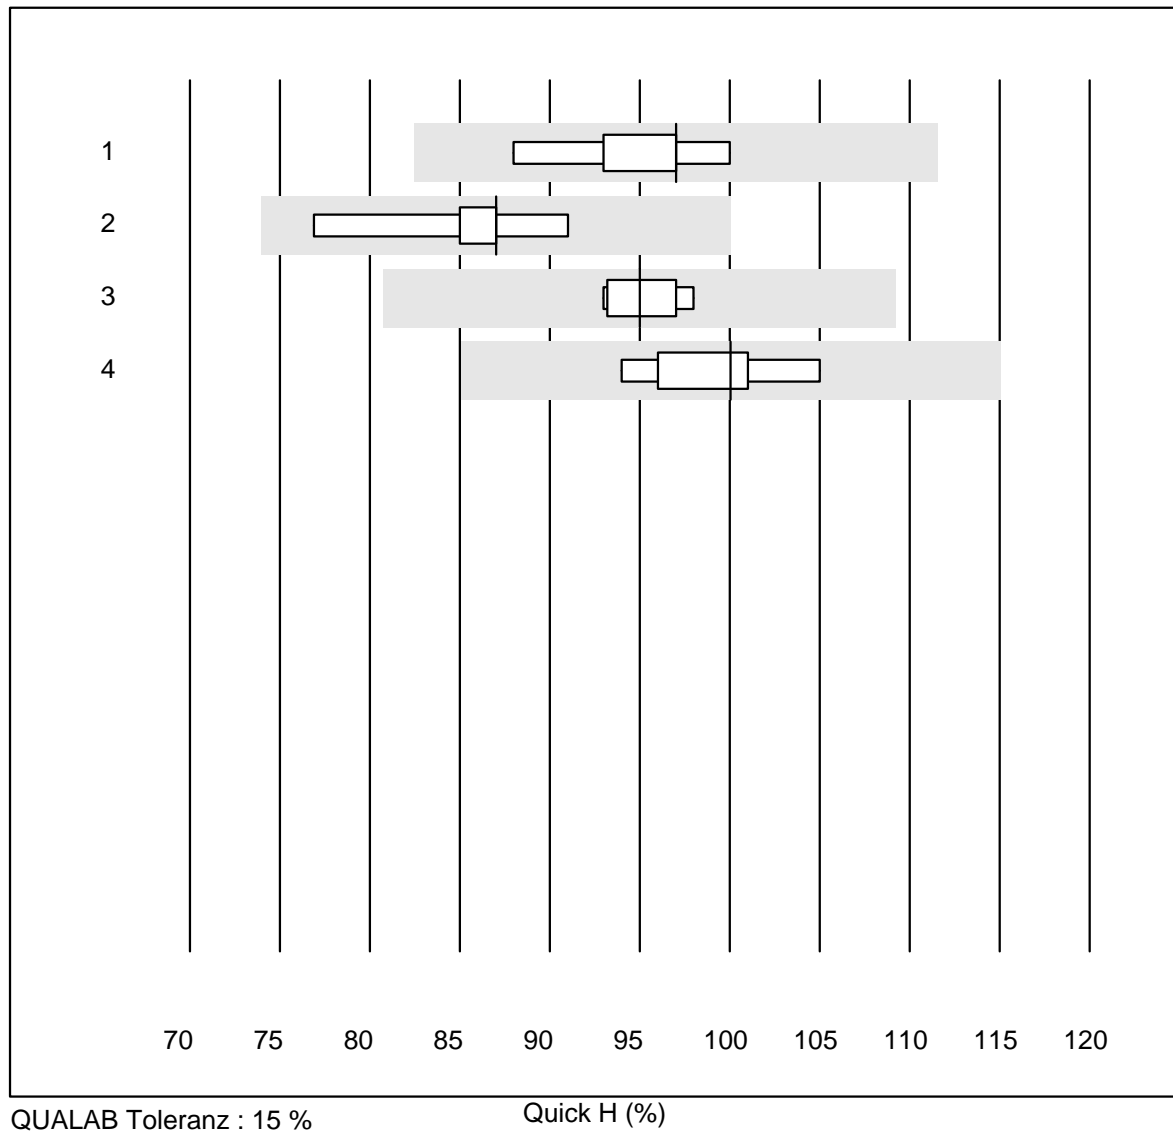

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Neoplastin R	9	100.0	0.0	0.0	97	3.8	e
2 Innovin	9	100.0	0.0	0.0	87	4.4	e
3 toutes les méthodes	9	88.9	0.0	11.1	95	2.1	e
4 Recombiplastin 2G	6	100.0	0.0	0.0	100	3.9	e

## Anti-FXa (unfrakt-Heparin)

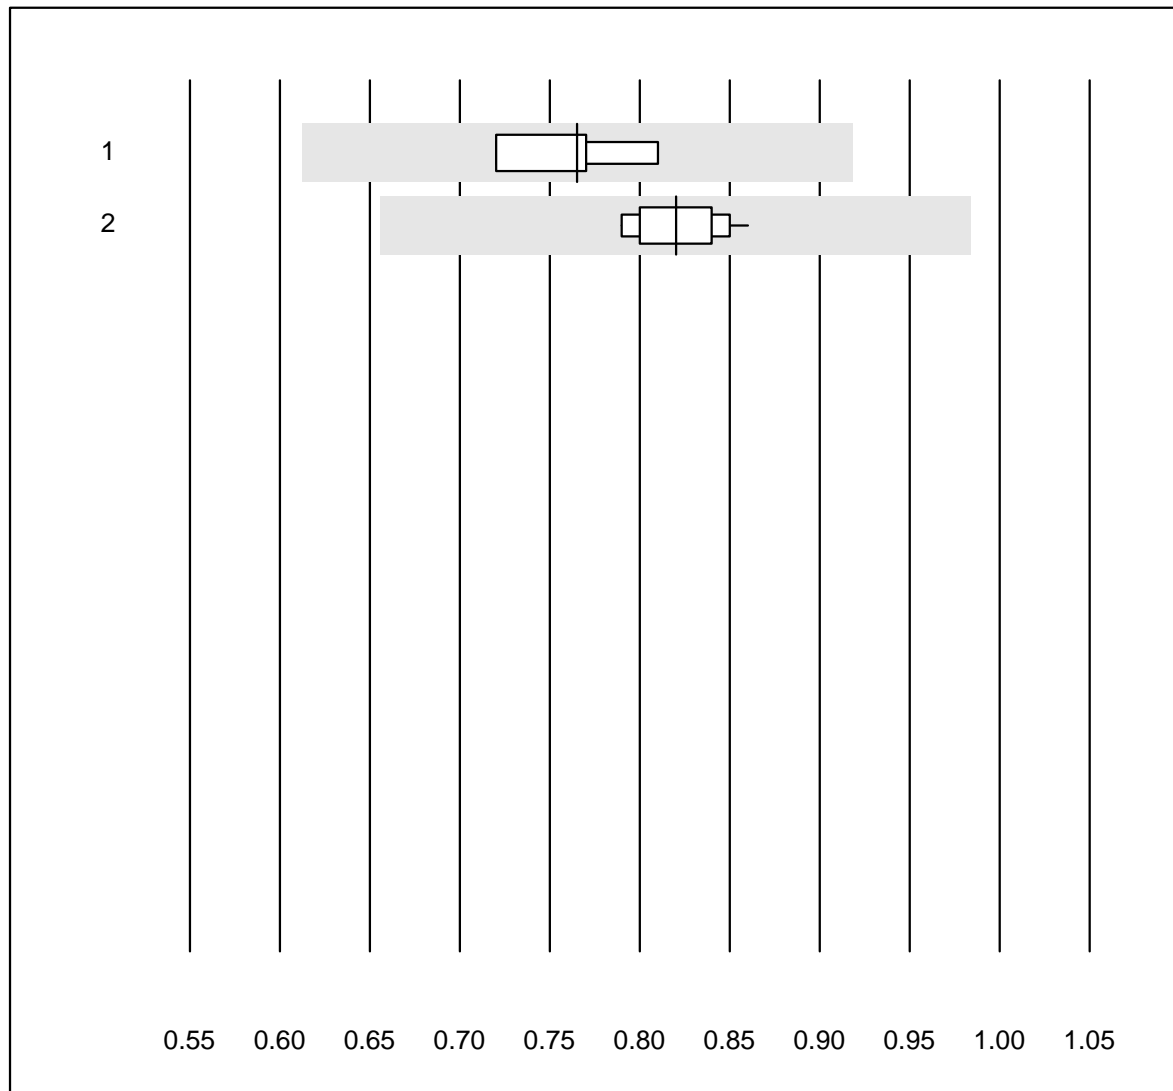


Tolérance MQ : 20 %

Anti-FXa (unfrakt-Heparin) (IU/ml)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Stago/STA	4	100.0	0.0	0.0	0.77	4.8	e*
2	ACL	10	100.0	0.0	0.0	0.82	3.1	e


## Fibrinogen H

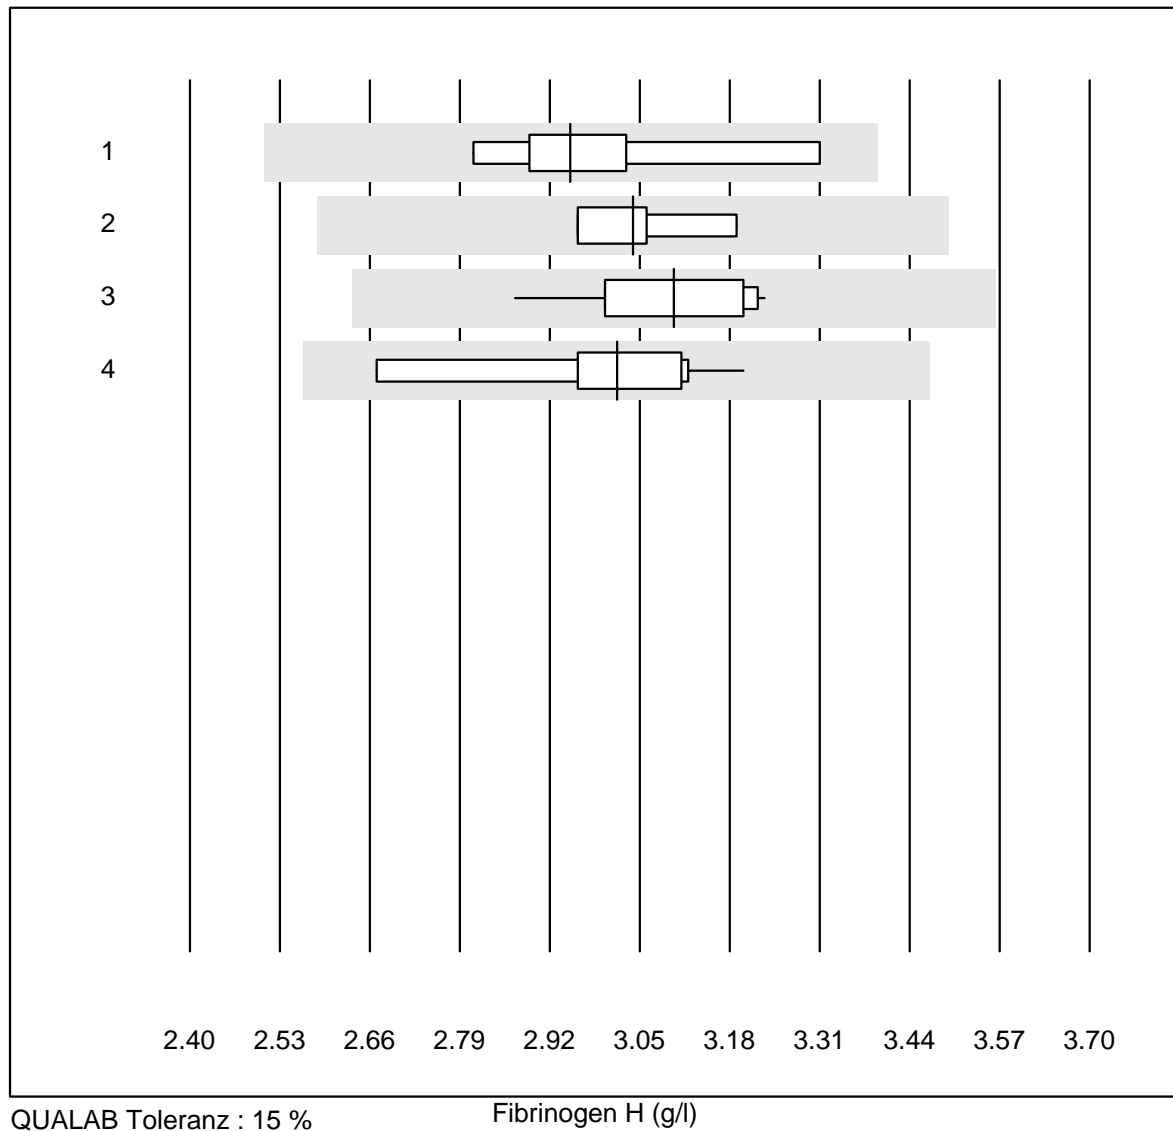

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Siemens Thrombin	5	100.0	0.0	0.0	2.95	6.4	e*
2	Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	3.04	3.2	e
3	Stago/STA	12	100.0	0.0	0.0	3.10	3.5	e
4	Fibrinogen Q.F.A.	10	100.0	0.0	0.0	3.02	4.7	e




## aPTT H

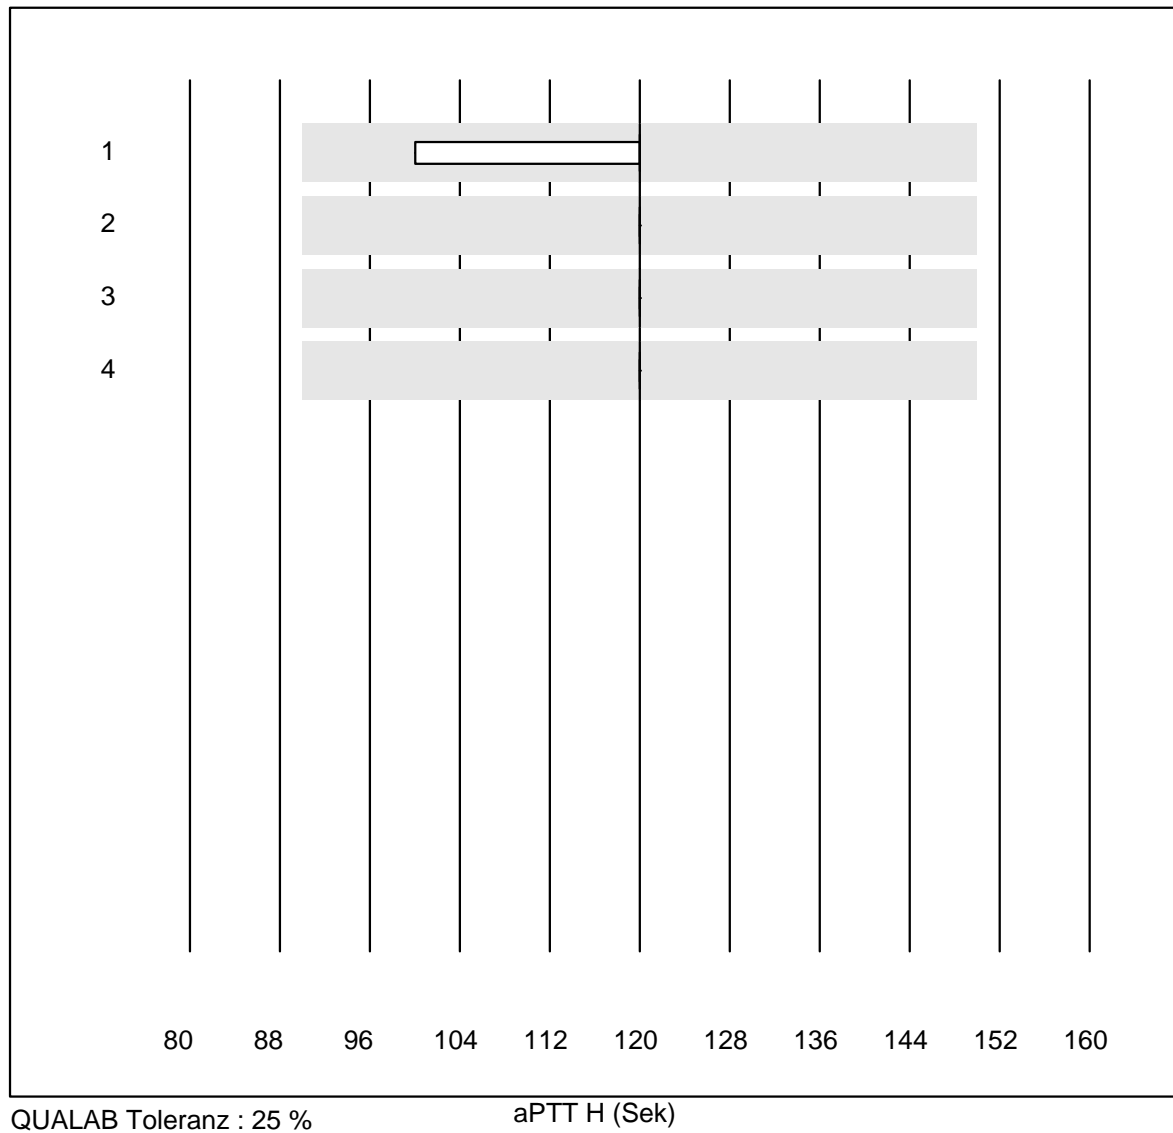


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Actin FS	5	100.0	0.0	0.0	120.0	7.7	e*
2	Autres méthodes	5	100.0	0.0	0.0	120.0	0.0	e
3	Stago/STA	8	100.0	0.0	0.0	120.0	0.0	e
4	aPTT-SP	11	100.0	0.0	0.0	120.0	0.0	e

## D-Dimères

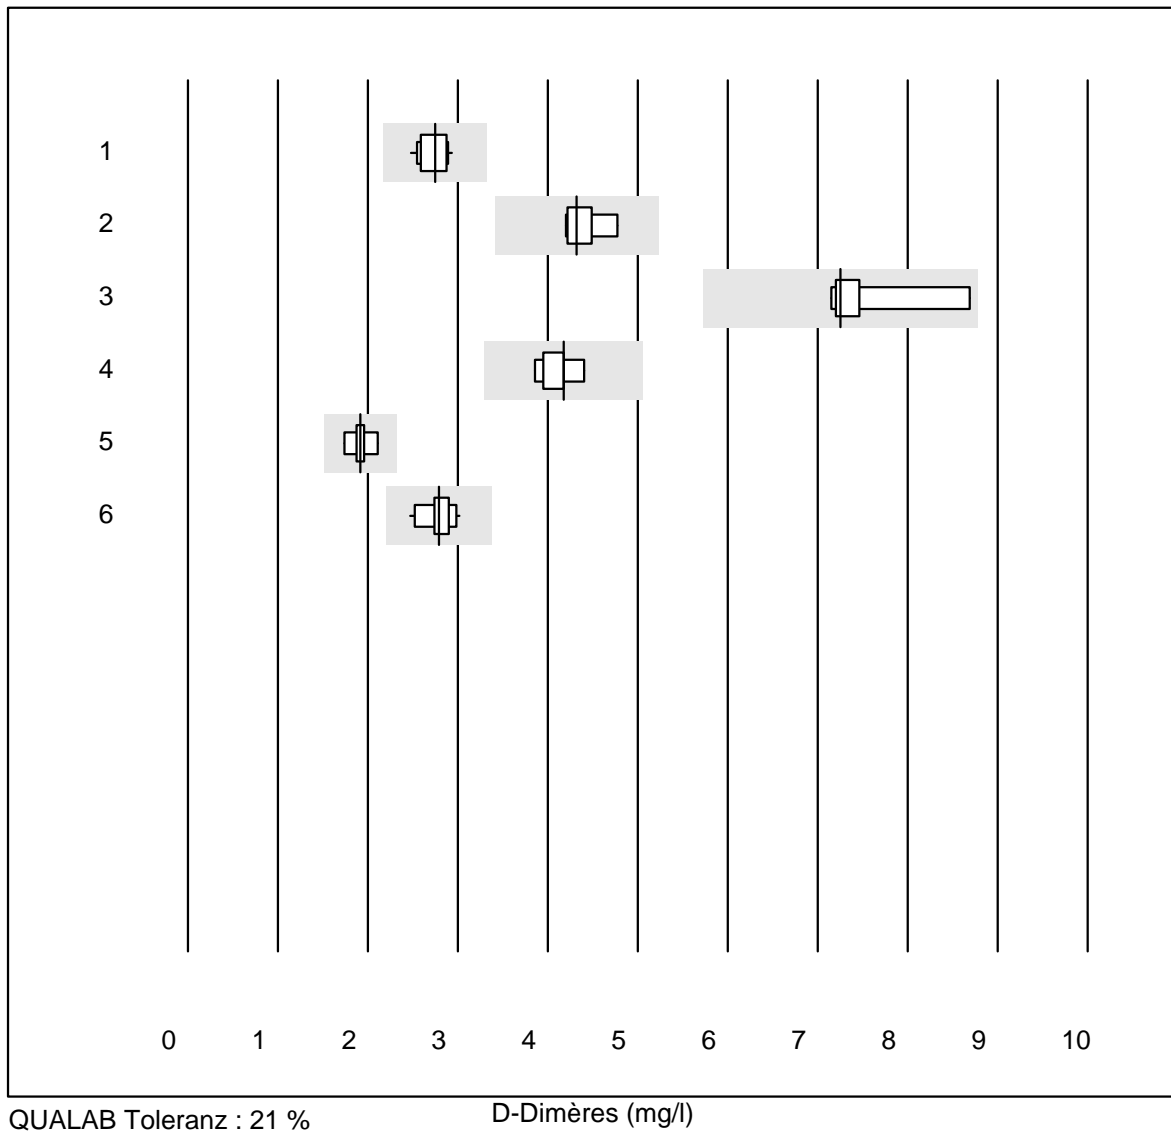


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	STA Liatest	12	100.0	0.0	0.0	2.75	5.3	e
2	Siemens Innovance	7	100.0	0.0	0.0	4.32	4.5	e
3	Eurolyser	6	83.3	0.0	16.7	7.26	8.5	e*
4	ACL	8	100.0	0.0	0.0	4.17	4.0	e
5	AQT 90 FLEX	9	100.0	0.0	0.0	1.92	5.9	e
6	VIDAS	18	100.0	0.0	0.0	2.79	5.7	e

## CoaguChek APTT

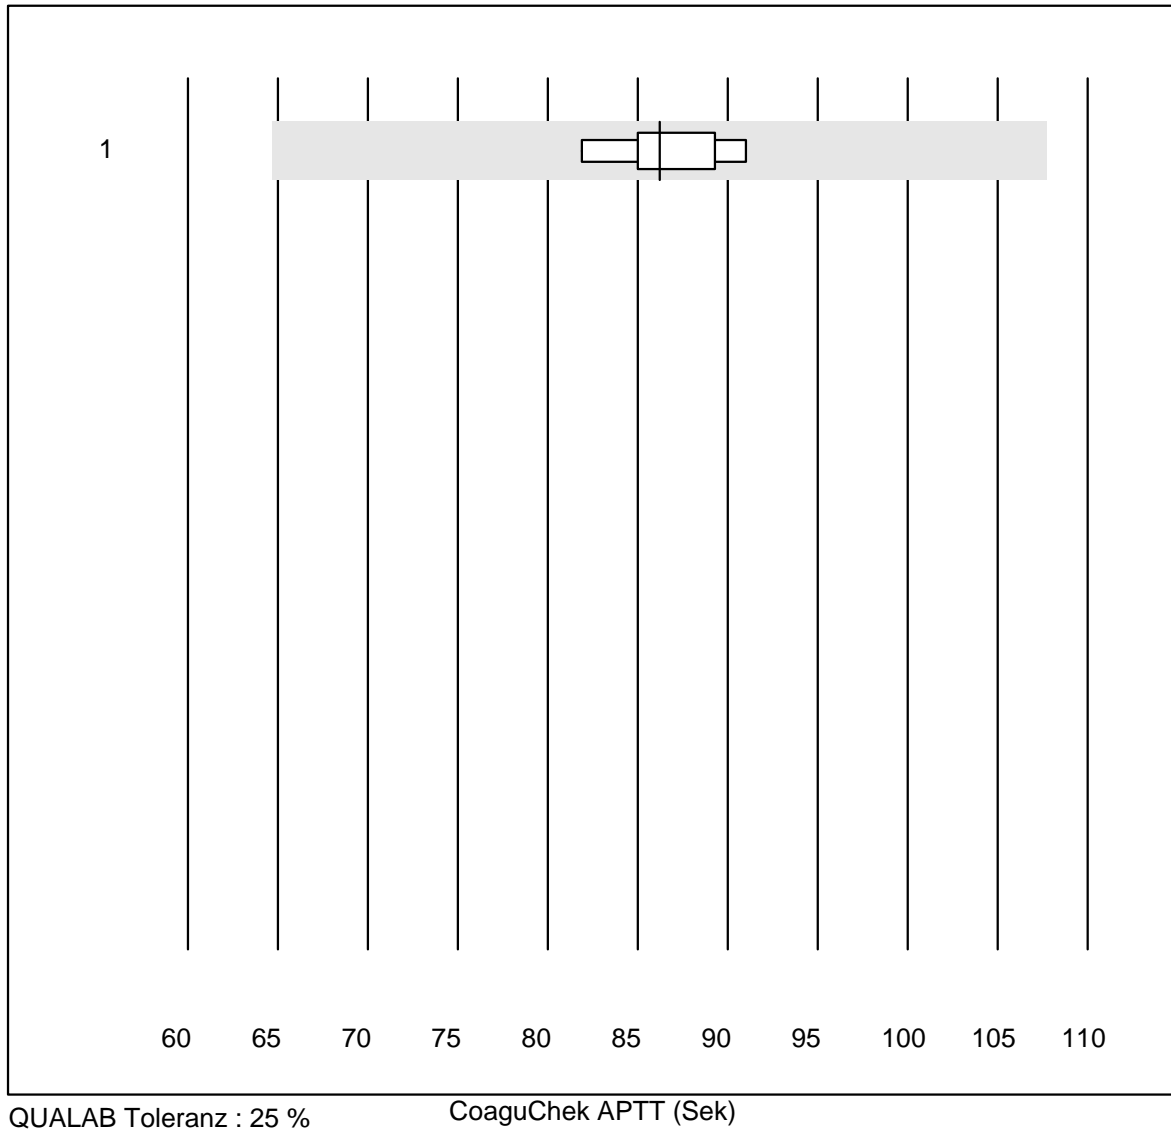

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 CoaguChek Pro II	7	100.0	0.0	0.0	86.2	3.6	e

## INR CCXS

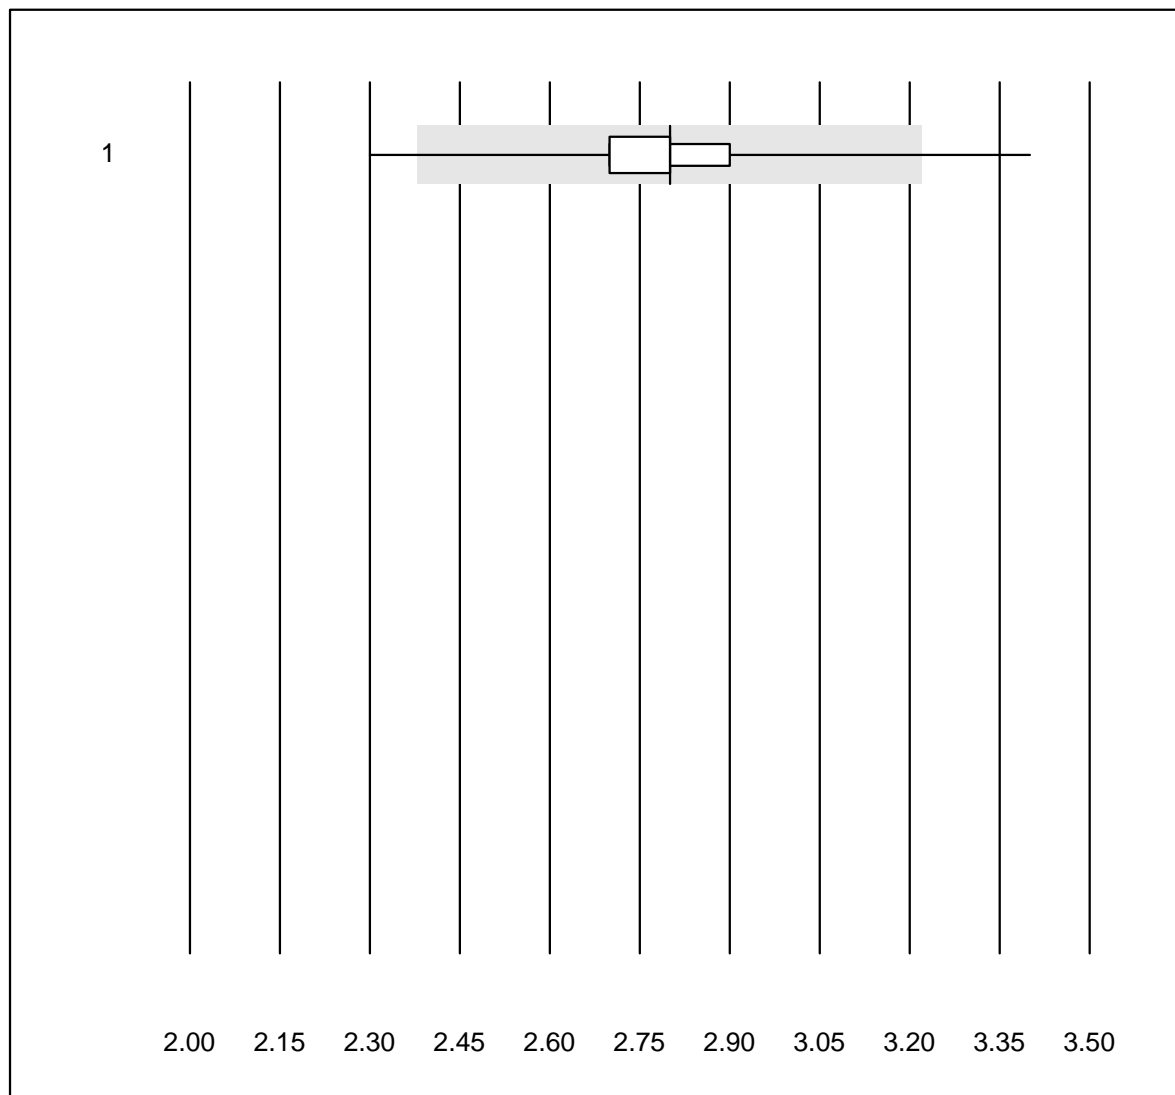


QUALAB Toleranz : 15 %

INR CCXS ()

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 CoaguChek XS	1775	99.0	0.2	0.8	2.8	3.6	e

# INR HC

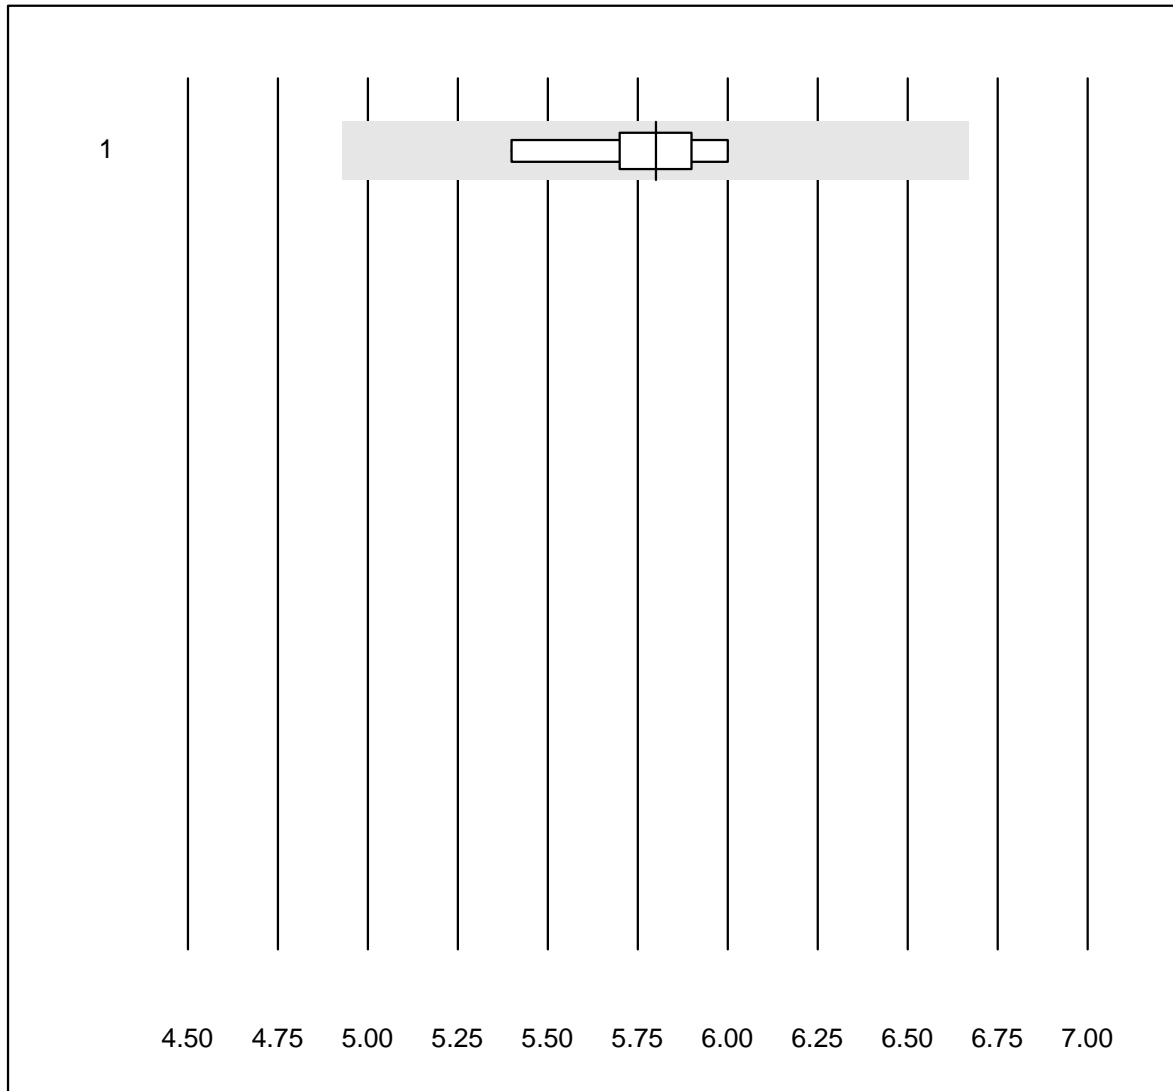


QUALAB Toleranz : 15 %

INR HC ()

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Hemochron j.	9	100.0	0.0	0.0	5.8	3.3	e

## INR MI

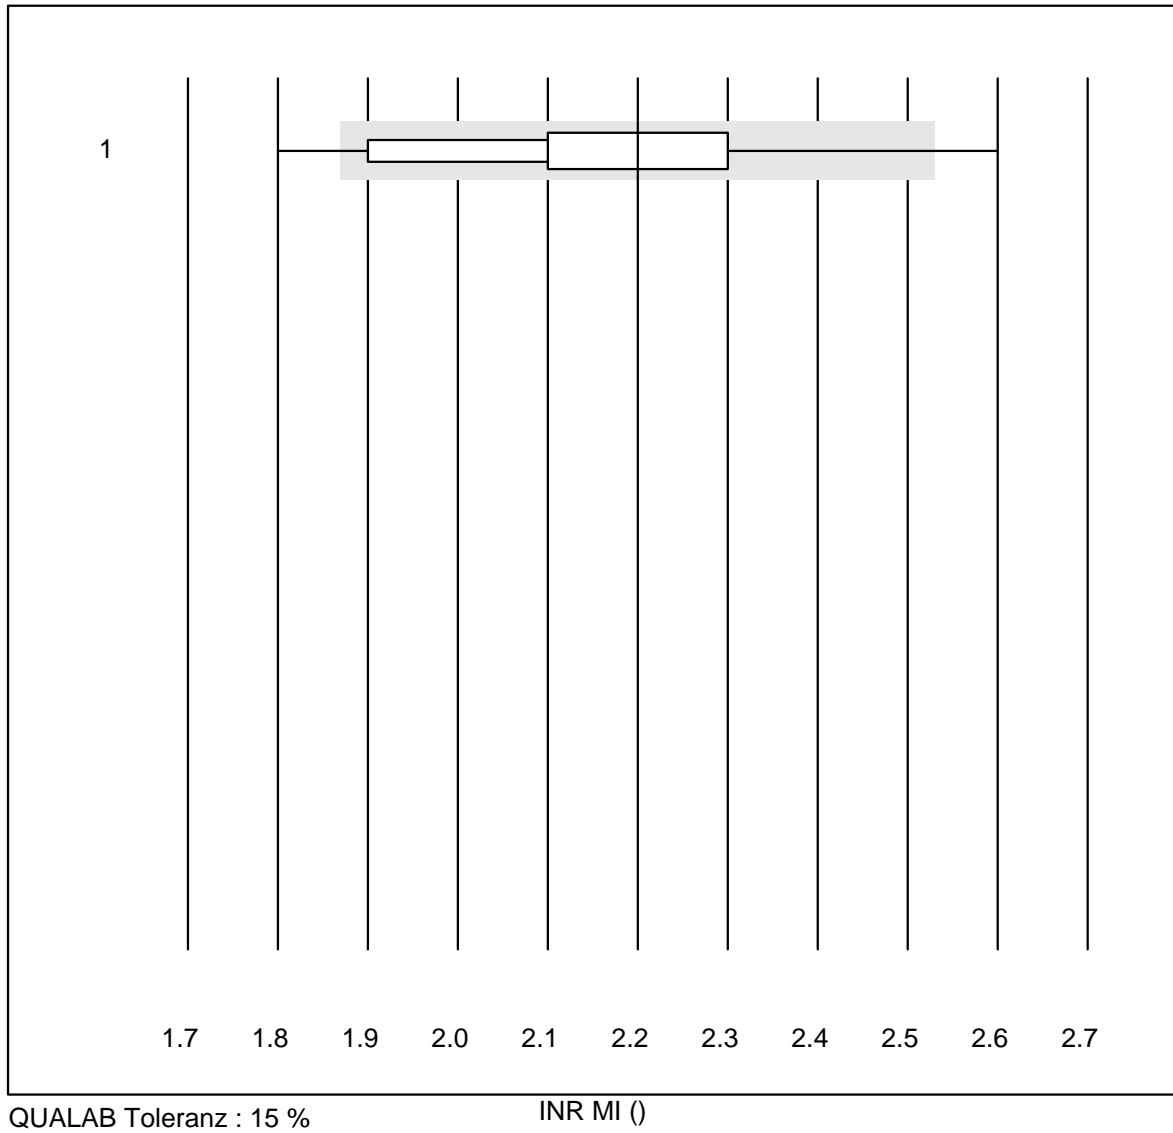


QUALAB Toleranz : 15 %

INR MI ( )


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 MicroINR	128	84.4	8.6	7.0	2.2	7.8	e

## INR Xprecia

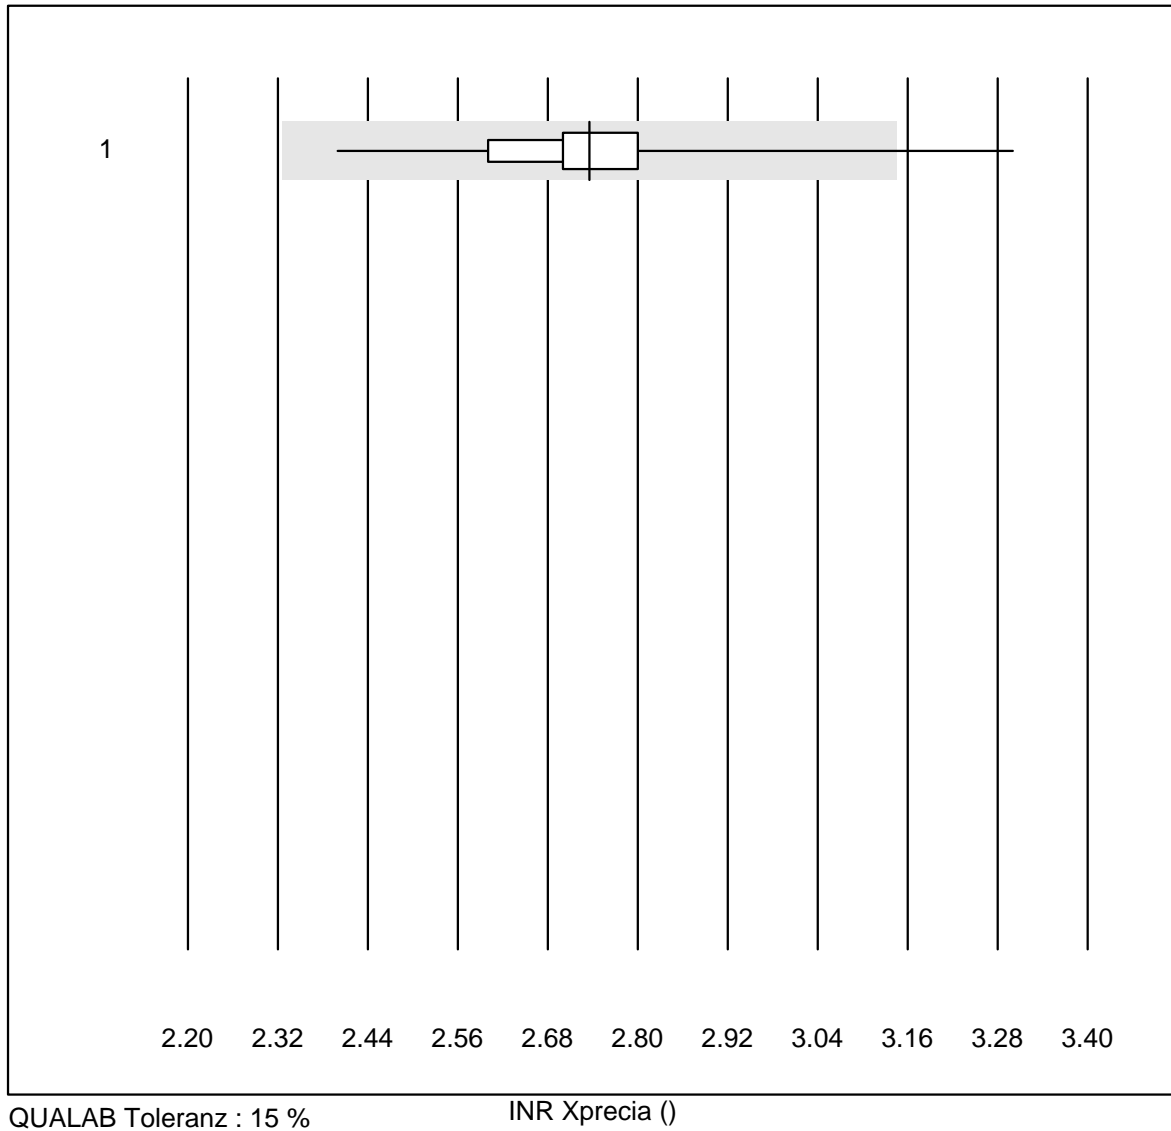

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Xprecia	61	96.8	1.6	1.6	2.7	4.5	e

## INR Lumira Dx

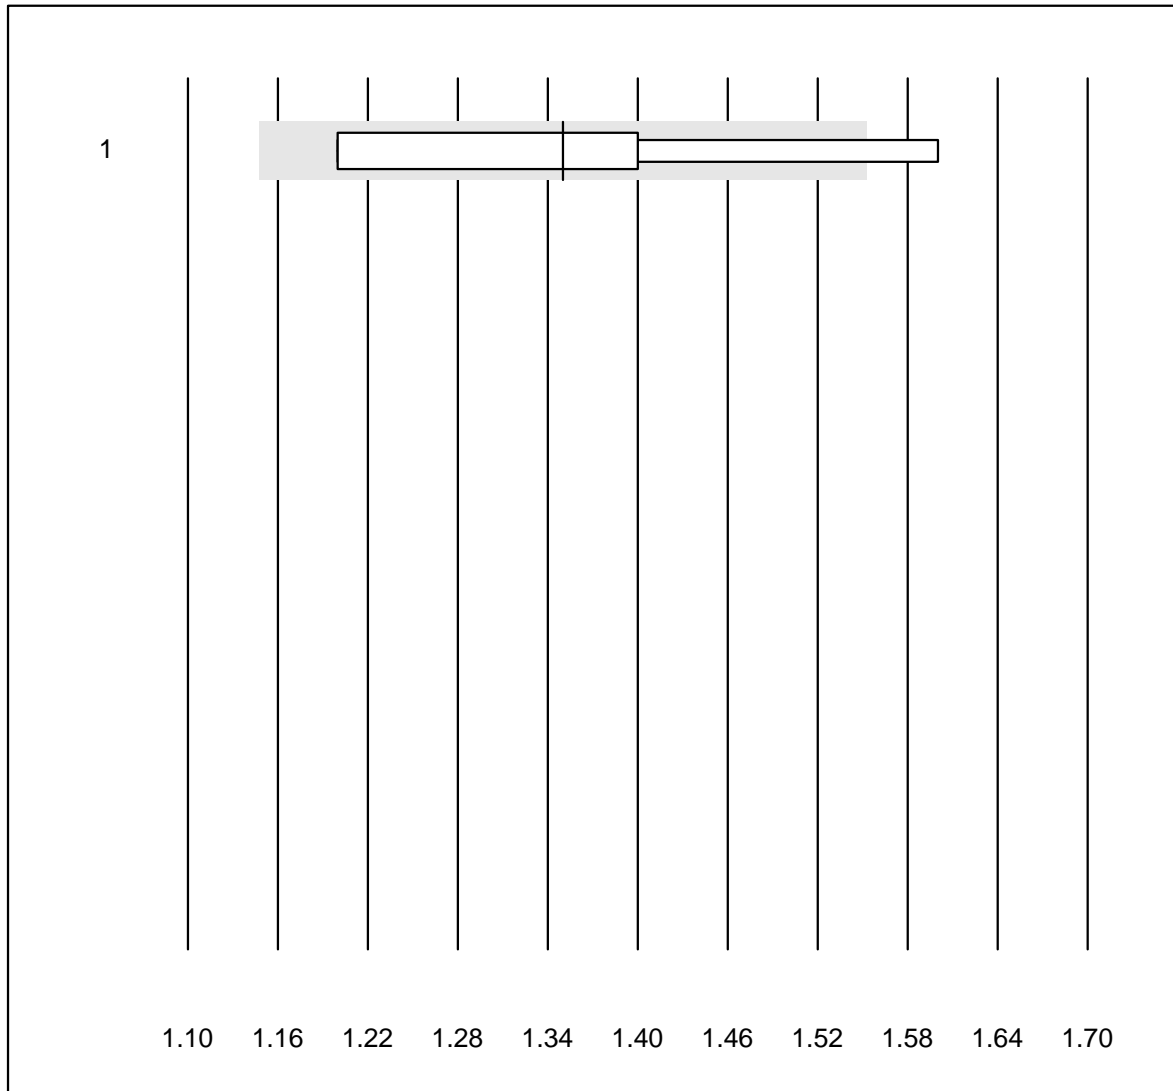


QUALAB Toleranz : 15 %

INR Lumira Dx ()

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Lumira Dx	4	75.0	25.0	0.0	1.4	12.4	e*



## Anti-FXa (LMW-Heparin)

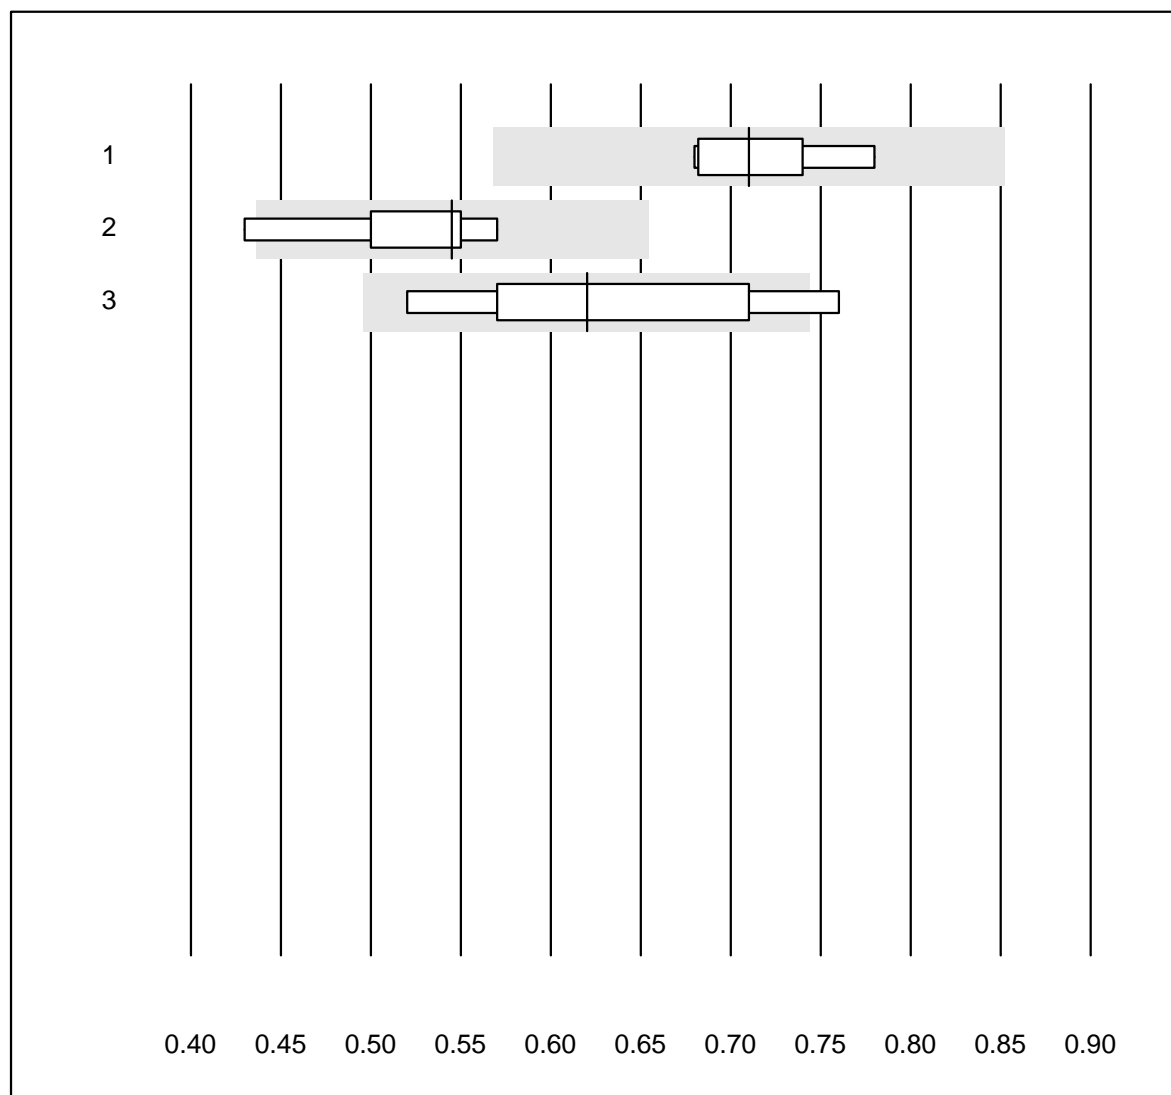


Tolérance MQ : 20 %

Anti-FXa (LMW-Heparin) (IU/ml)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	0.71	5.9	e*
2 Stago/STA	8	87.5	12.5	0.0	0.55	8.7	e*
3 ACL	9	88.9	11.1	0.0	0.62	13.1	a

## Anti-FXa (Rivaroxaban)

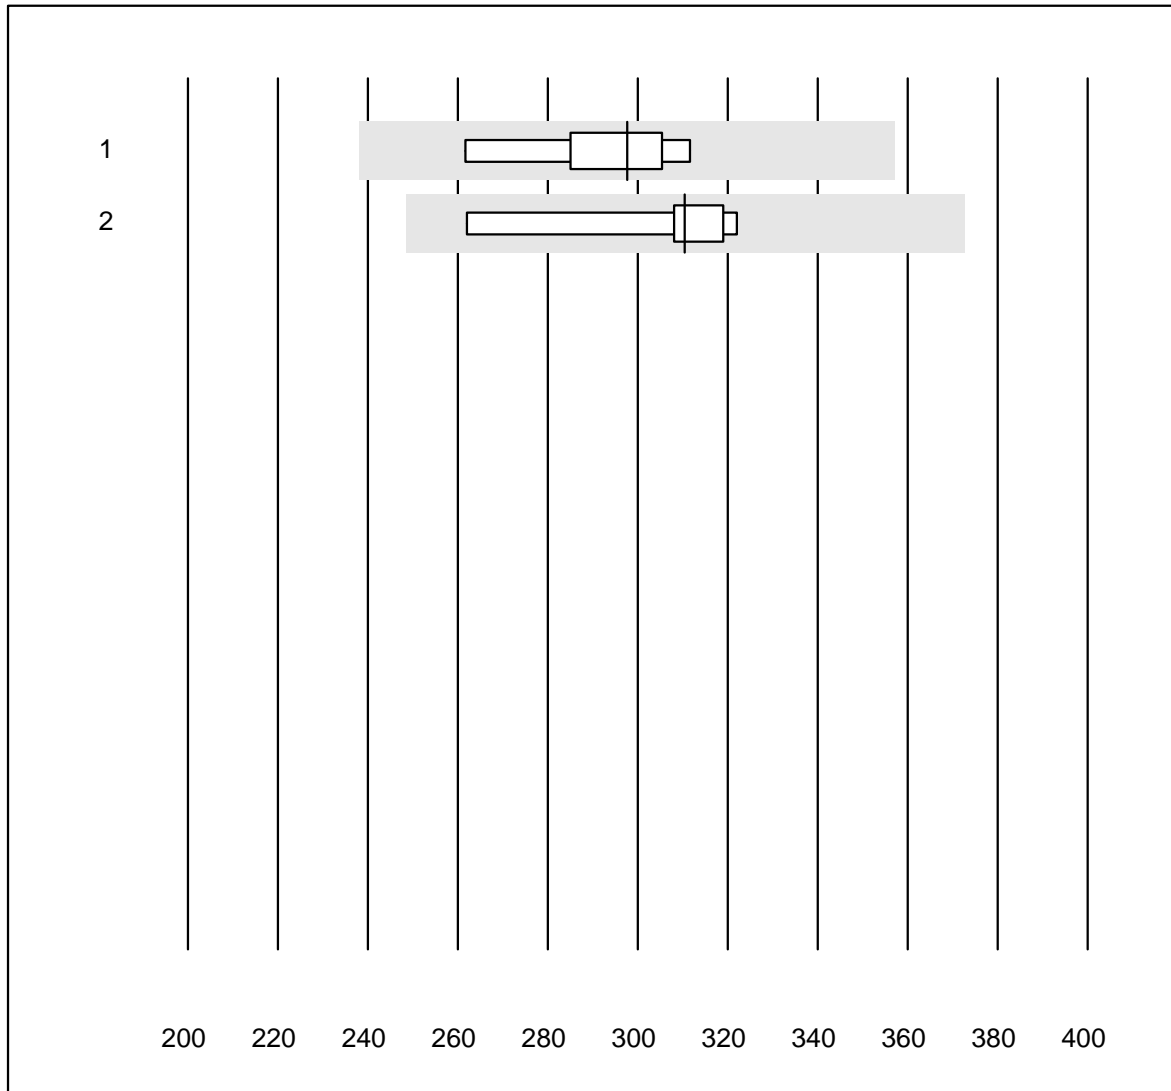


Tolérance MQ : 20 %

Anti-FXa (Rivaroxaban) (µg/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	8	100.0	0.0	0.0	297.65	5.6	e
2 Stago/STA	6	100.0	0.0	0.0	310.50	7.2	e*

## Anti-FXa (Apixaban)

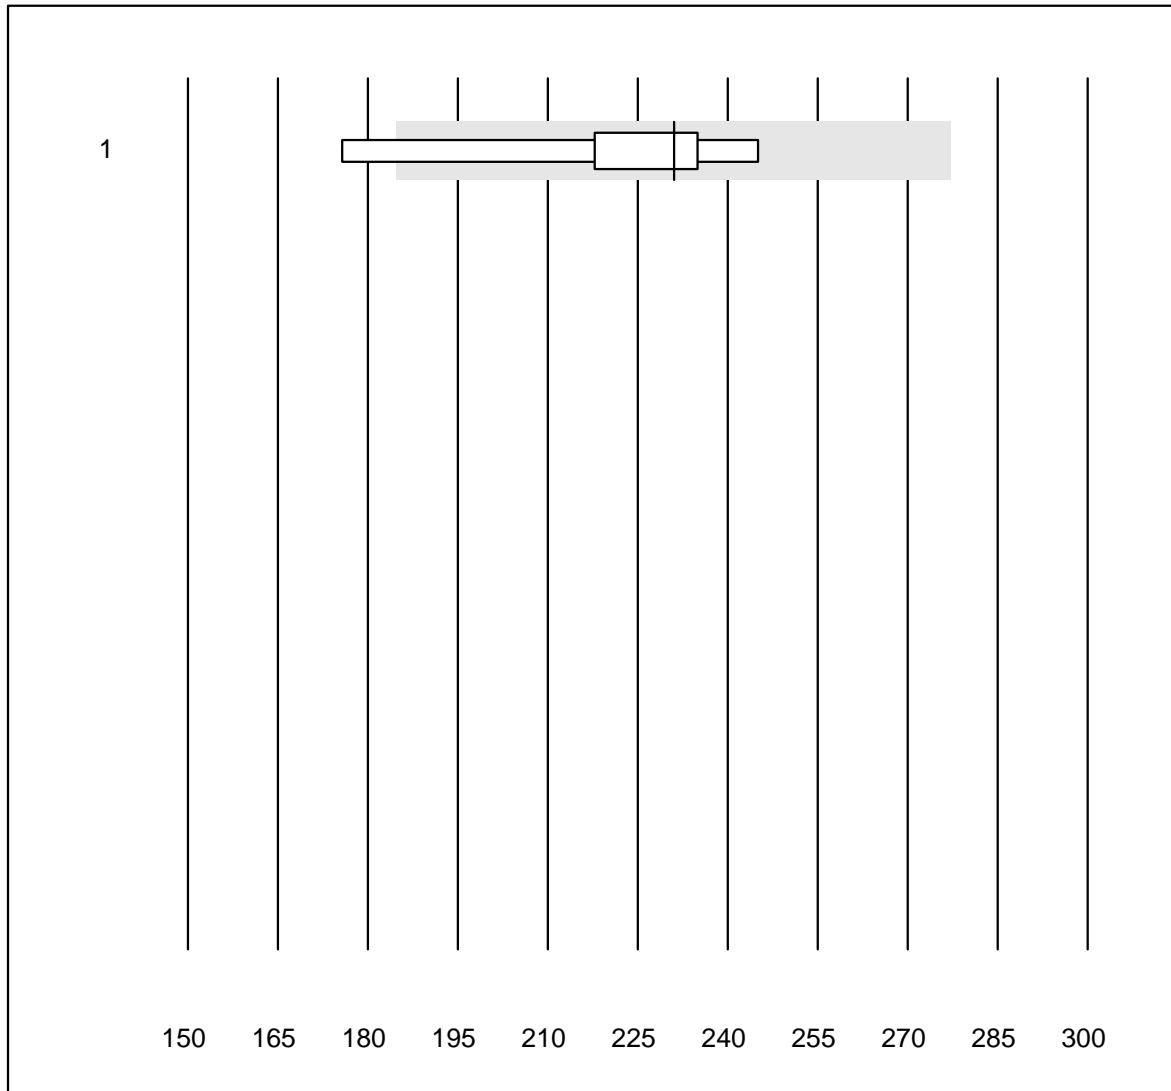


Tolérance MQ : 20 %

Anti-FXa (Apixaban) (µg/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	7	71.4	14.3	14.3	231.00	11.0	e*

## Hémoglobine

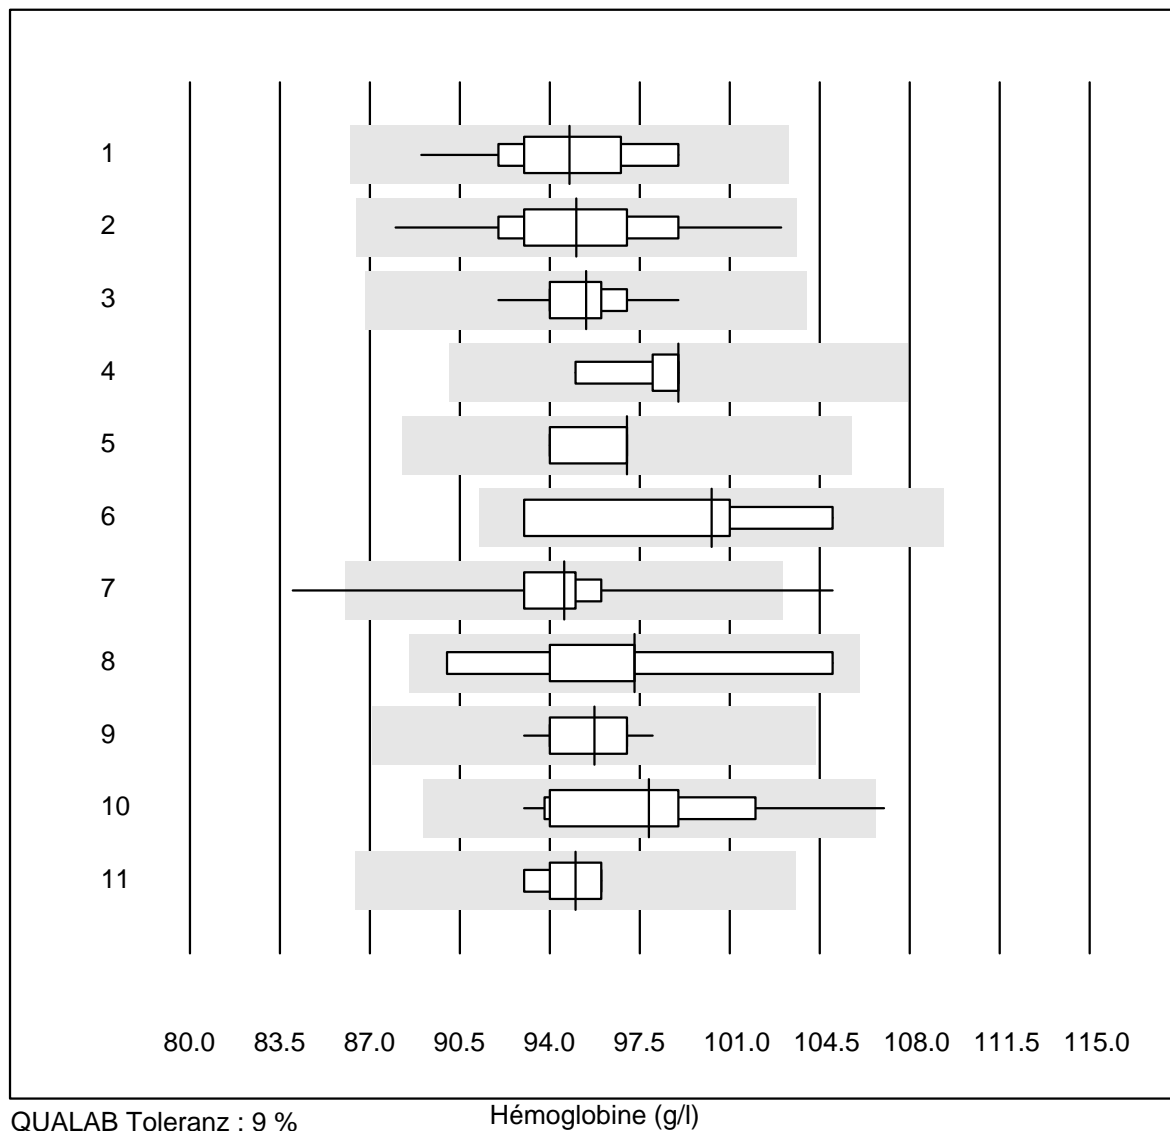


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Automate	17	100.0	0.0	0.0	94.8	2.9	e
2 Cyanmethémoglobine	28	96.4	0.0	3.6	95.0	3.3	e
3 Sysmex X	43	97.7	0.0	2.3	95.4	1.6	e
4 Advia 120	5	100.0	0.0	0.0	99.0	1.8	e
5 Yumizen/Pentra	4	100.0	0.0	0.0	97.0	1.6	e
6 Reflotron	4	100.0	0.0	0.0	100.3	5.0	e*
7 Hemocue	400	95.4	0.8	3.8	94.6	2.1	e
8 Dr. Lange	7	71.4	0.0	28.6	97.3	5.8	e*
9 Hemocontrol	11	100.0	0.0	0.0	95.7	1.8	e
10 DiaSpect	17	88.2	5.9	5.9	97.9	3.8	e
11 Sysmex	6	100.0	0.0	0.0	95.0	1.2	e

## Hémoglobine

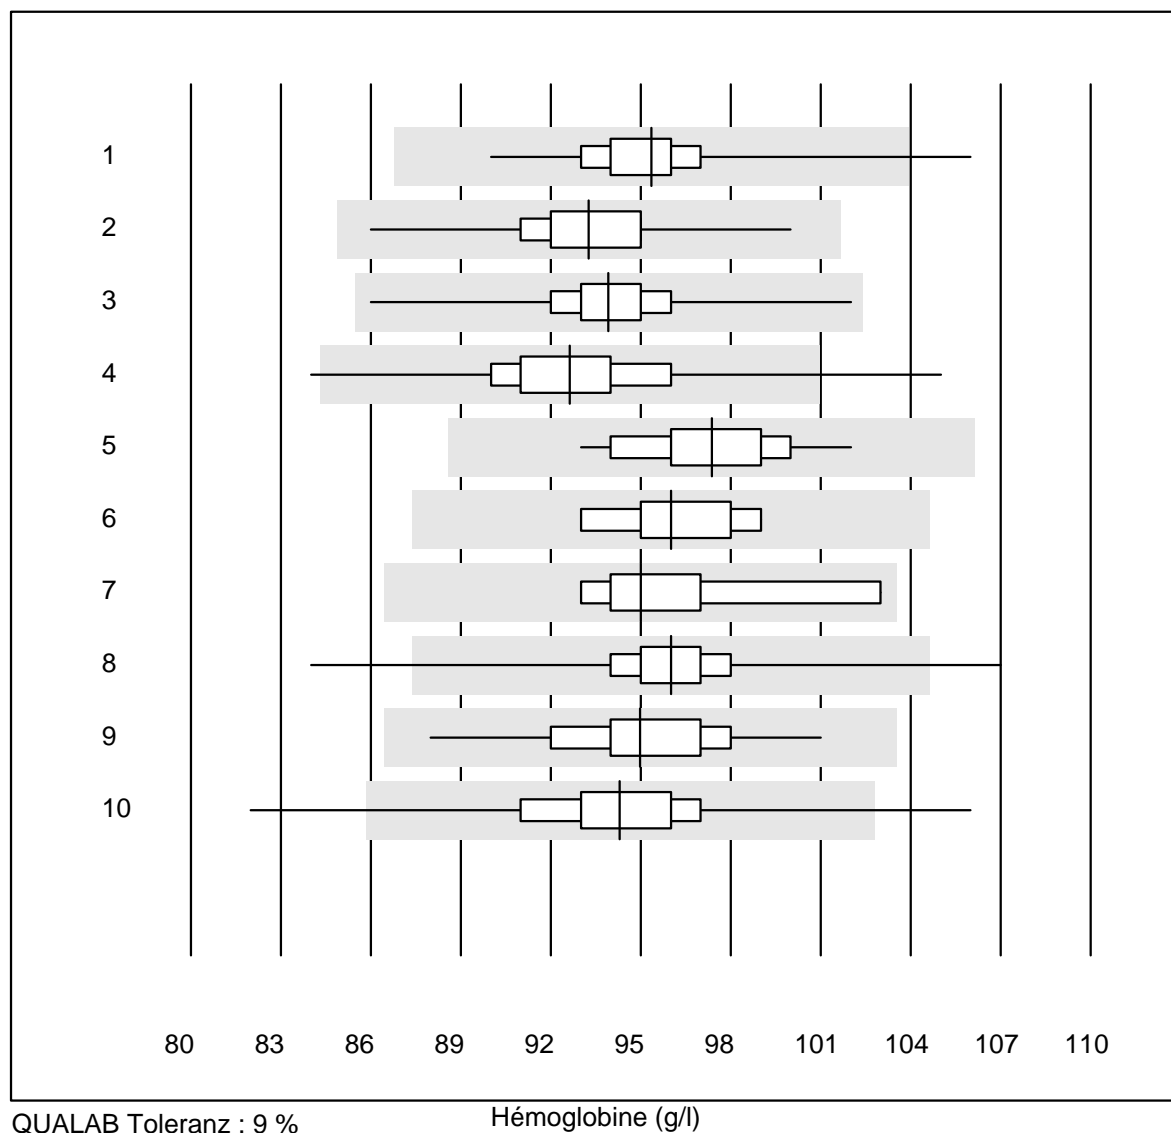


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex KX21	238	98.3	0.4	1.3	95.3	2.1	e
2	Sysmex PochH - 100i	196	99.0	0.0	1.0	93.3	2.3	e
3	Sysmex XP 300	549	98.5	0.0	1.5	93.9	1.7	e
4	Mythic	283	97.5	0.7	1.8	92.6	2.9	e
5	Swelab	36	97.2	0.0	2.8	97.4	2.2	e
6	Abacus Junior	5	100.0	0.0	0.0	96.0	2.5	e*
7	Medonic	7	100.0	0.0	0.0	95.0	3.4	e*
8	Celltac Alpha (Nihon	83	91.6	2.4	6.0	96.0	2.7	e
9	Samsung HC10	33	97.0	0.0	3.0	95.0	3.0	e
10	Micros 60	166	92.8	4.2	3.0	94.3	3.7	e

## Hématocrite

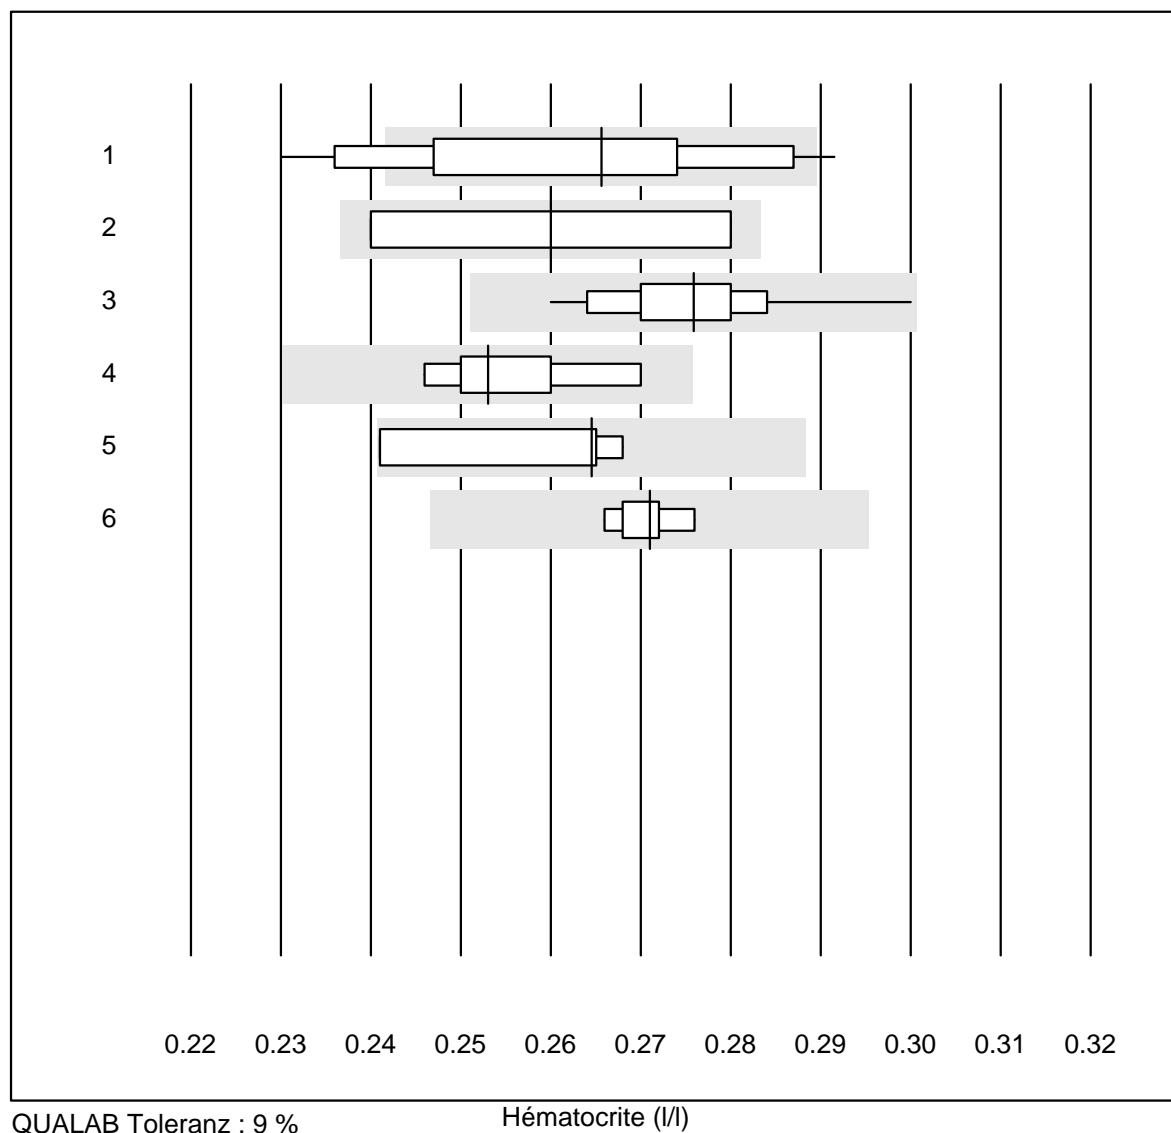

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Automate	15	73.3	20.0	6.7	0.27	7.3	e*
2	Centrifuge	5	60.0	0.0	40.0	0.26	7.7	e*
3	Sysmex X	43	97.7	0.0	2.3	0.28	3.1	e
4	Advia 120	5	100.0	0.0	0.0	0.25	3.7	e*
5	Yumizen/Pentra	4	100.0	0.0	0.0	0.26	4.8	e*
6	Sysmex	6	100.0	0.0	0.0	0.27	1.3	e

## Hématocrite

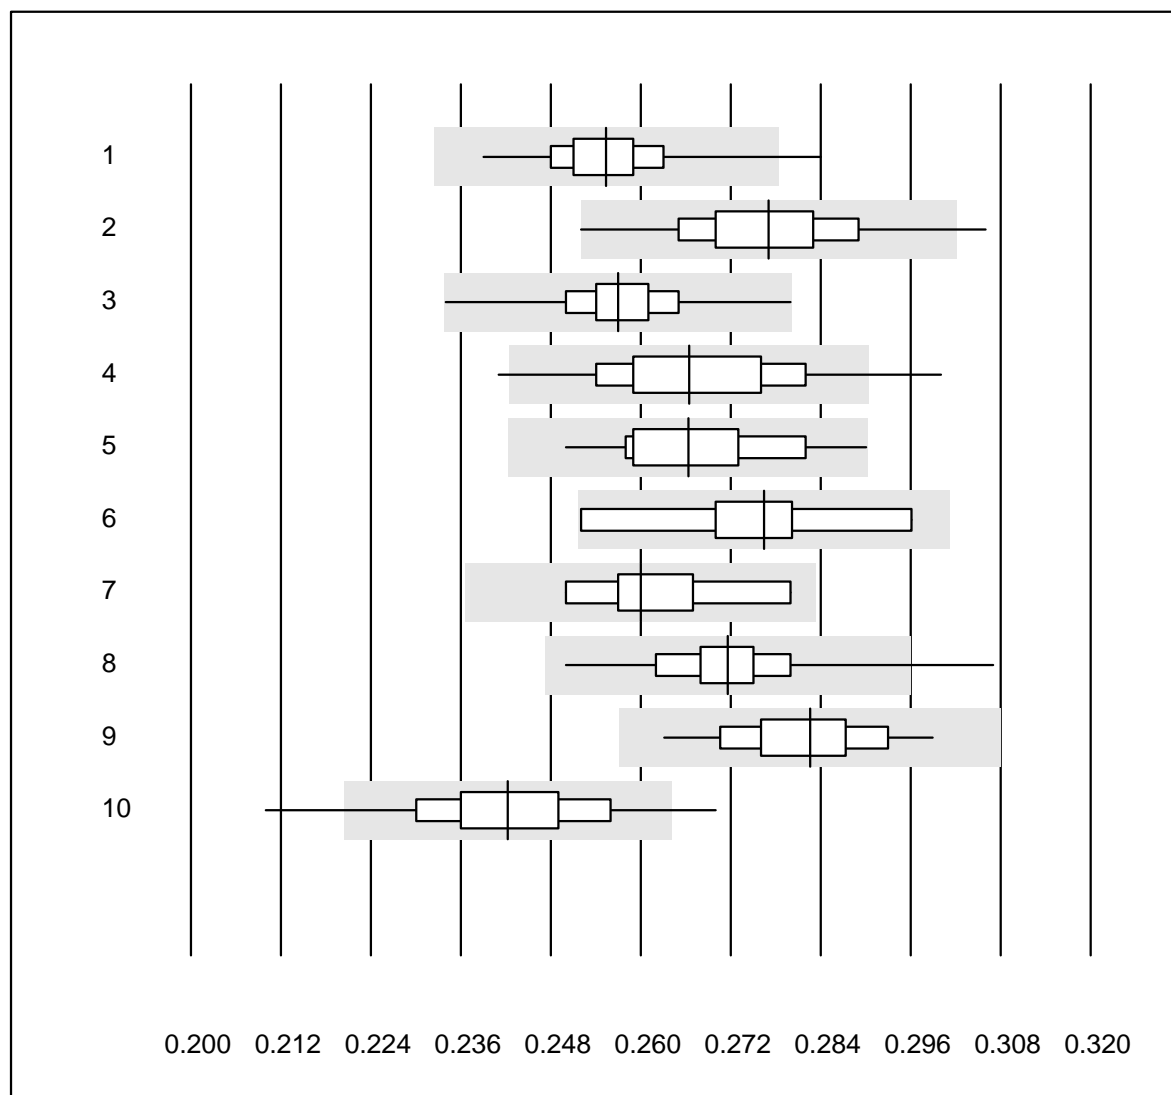


QUALAB Toleranz : 9 %

Hématocrite (l/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex KX21	238	97.5	0.8	1.7	0.26	2.7	e
2	Sysmex PochH - 100i	195	97.5	1.5	1.0	0.28	3.7	e
3	Sysmex XP 300	551	98.7	0.0	1.3	0.26	2.3	e
4	Mythic	284	95.0	2.5	2.5	0.27	4.1	e
5	Swelab	36	97.2	0.0	2.8	0.27	3.6	e
6	Abacus Junior	5	100.0	0.0	0.0	0.28	5.8	e*
7	Medonic	7	100.0	0.0	0.0	0.26	3.6	e*
8	Celltac Alpha (Nihon	84	92.8	1.2	6.0	0.27	2.9	e
9	Samsung HC10	33	93.9	0.0	6.1	0.28	3.0	e
10	Micros 60	166	91.0	5.4	3.6	0.24	4.4	e

## Erythrocytes

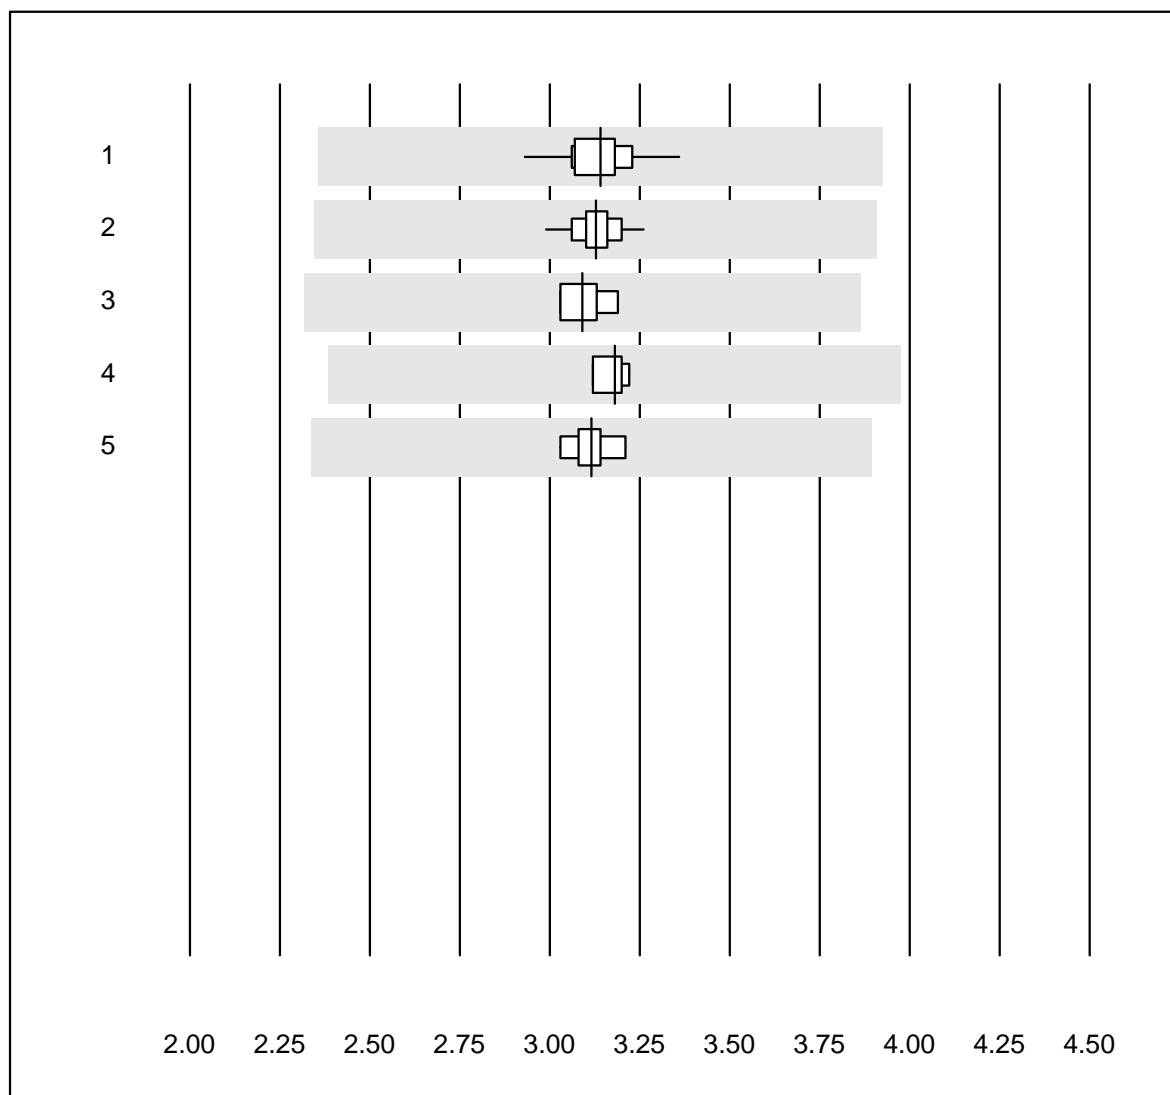


QUALAB Toleranz : 25 %

Erythrocytes (T/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Automate	13	100.0	0.0	0.0	3.14	3.3	e
2 Sysmex X	43	97.7	0.0	2.3	3.13	1.9	e
3 Advia 120	5	100.0	0.0	0.0	3.09	2.2	e
4 Yumizen/Pentra	4	100.0	0.0	0.0	3.18	1.4	e
5 Sysmex	6	100.0	0.0	0.0	3.12	1.9	e



# Erythrocytes

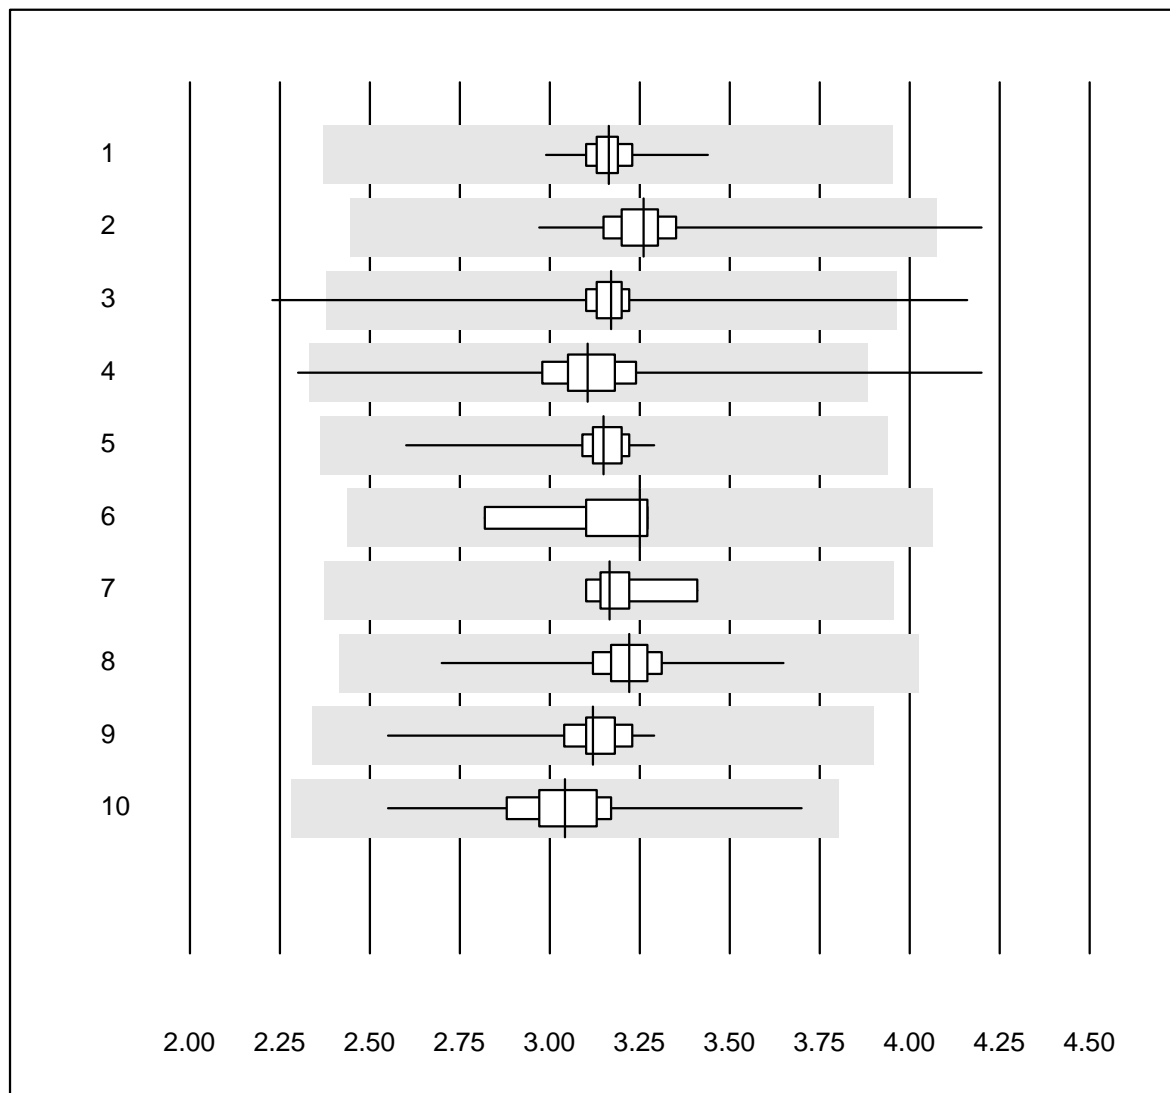


QUALAB Toleranz : 25 %

Erythrocytes (T/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex KX21	238	98.3	0.0	1.7	3.16	1.7	e
2	Sysmex PochH - 100i	196	98.5	0.5	1.0	3.26	3.4	e
3	Sysmex XP 300	550	98.2	0.9	0.9	3.17	3.4	e
4	Mythic	284	97.2	1.4	1.4	3.11	5.1	e
5	Swelab	36	100.0	0.0	0.0	3.15	3.4	e
6	Abacus Junior	5	100.0	0.0	0.0	3.25	6.2	e
7	Medonic	6	100.0	0.0	0.0	3.17	3.4	e
8	Celltac Alpha (Nihon	83	94.0	0.0	6.0	3.22	3.7	e
9	Samsung HC10	33	97.0	0.0	3.0	3.12	4.1	e
10	Micros 60	166	98.2	0.0	1.8	3.04	4.8	e

## Leucocytes

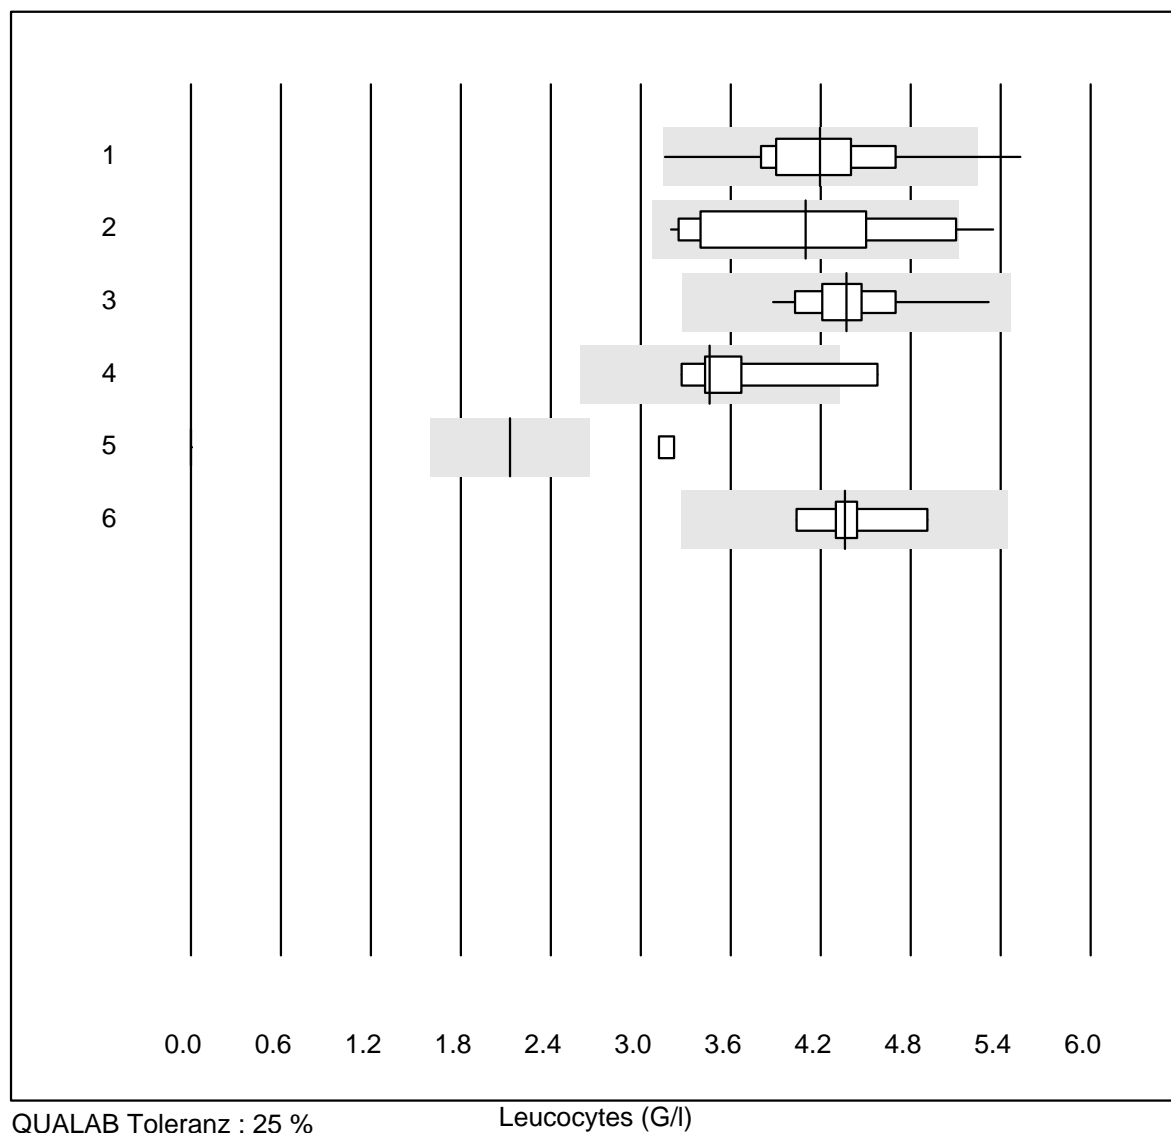


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Automate	11	90.9	9.1	0.0	4.20	14.0	e*
2	Microscopie	19	78.9	5.3	15.8	4.10	17.5	e*
3	Sysmex X	43	100.0	0.0	0.0	4.37	6.1	e
4	Advia 120 (Perox)	5	80.0	20.0	0.0	3.46	14.2	e*
5	Yumizen/Pentra	4	0.0	0.0	100.0	2.13	0.0	e
6	Sysmex	6	100.0	0.0	0.0	4.36	6.5	e

## Leucocytes

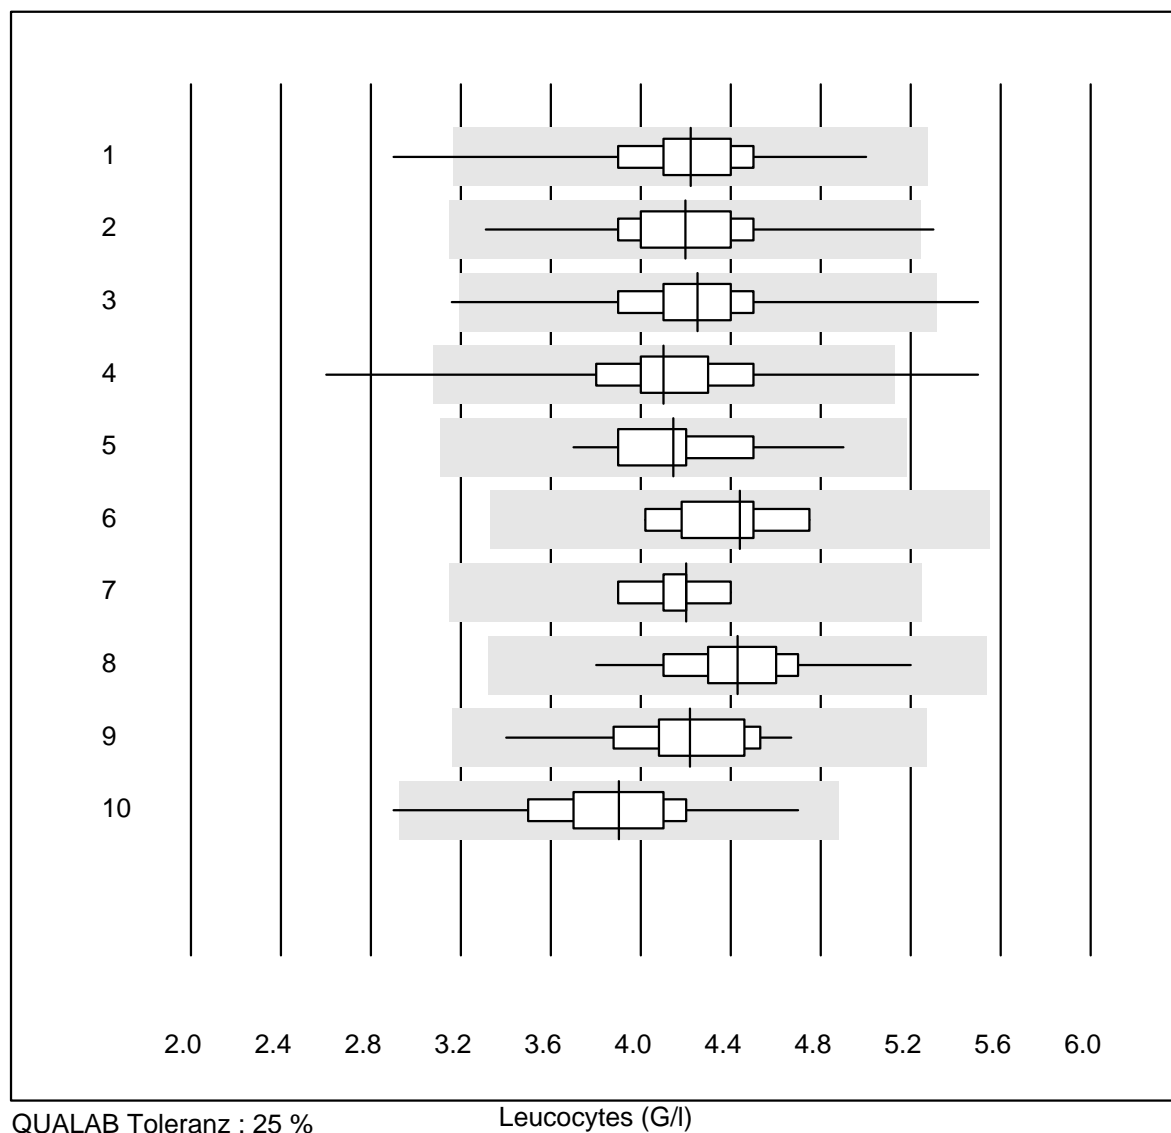

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex KX21	239	98.8	0.4	0.8	4.22	6.3	e
2	Sysmex PochH - 100i	196	98.5	0.5	1.0	4.20	6.5	e
3	Sysmex XP 300	551	99.1	0.4	0.5	4.25	5.9	e
4	Mythic	283	97.9	0.7	1.4	4.10	7.4	e
5	Swelab	36	100.0	0.0	0.0	4.15	6.2	e
6	Abacus Junior	5	100.0	0.0	0.0	4.44	6.5	e
7	Medonic	7	100.0	0.0	0.0	4.20	3.6	e
8	Celltac Alpha (Nihon	84	97.6	0.0	2.4	4.43	5.4	e
9	Samsung HC10	33	93.9	0.0	6.1	4.22	6.8	e
10	Micros 60	166	98.8	0.6	0.6	3.90	8.1	e

## Thrombocytes

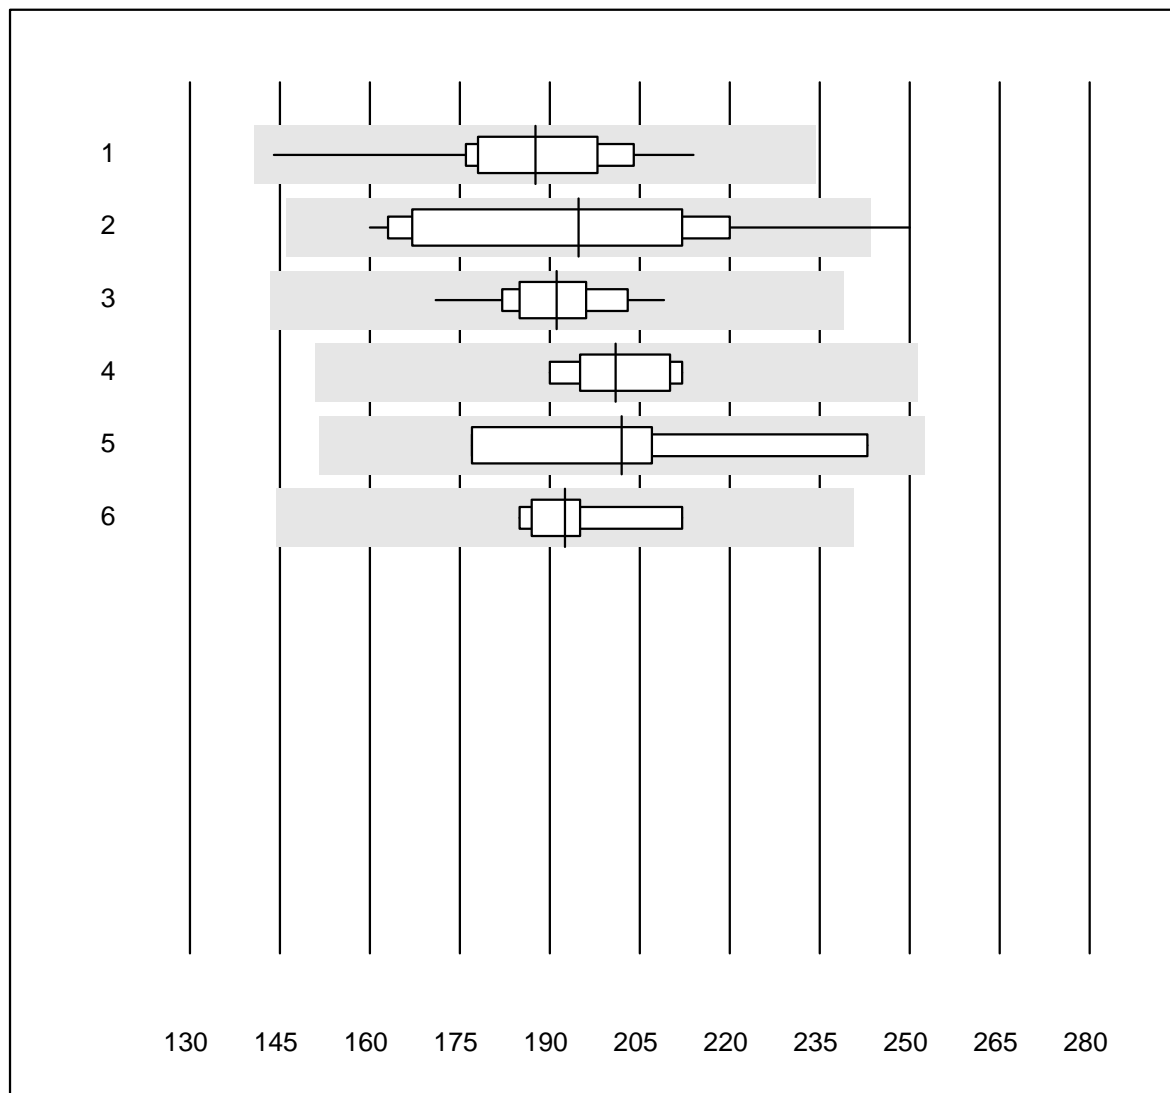


QUALAB Toleranz : 25 %

Thrombocytes (G/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Automate	11	100.0	0.0	0.0	187.5	9.7	e
2 Microscopie	12	91.7	8.3	0.0	194.8	14.6	e*
3 Sysmex X	43	97.7	0.0	2.3	191.1	4.4	e
4 Advia 120	5	100.0	0.0	0.0	201.0	4.7	e
5 Yumizen/Pentra	4	100.0	0.0	0.0	202.0	13.4	e*
6 Sysmex	6	100.0	0.0	0.0	192.5	5.0	e

## Thrombocytes

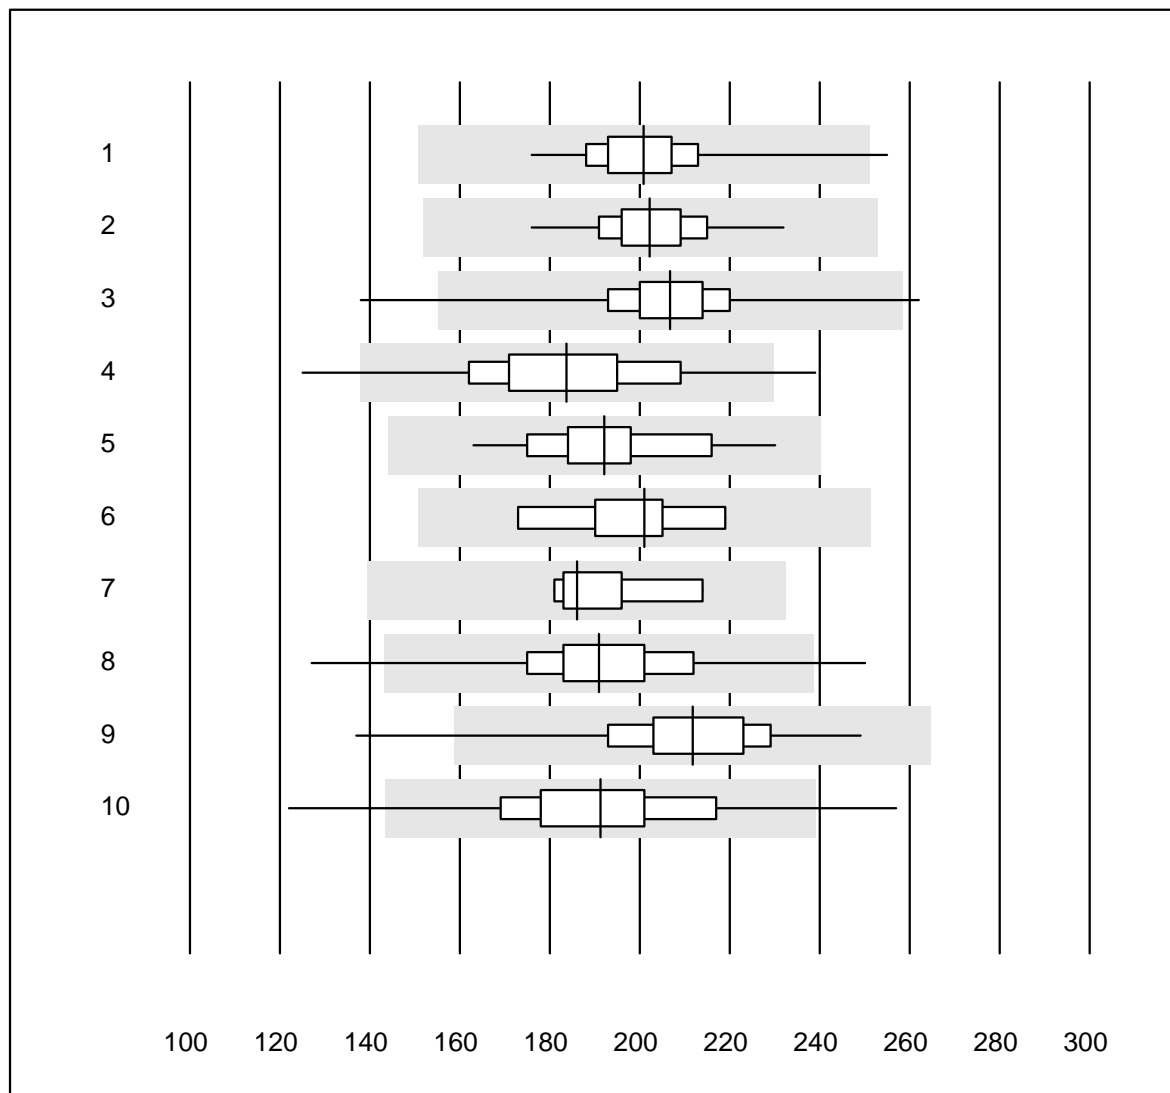

QUALAB Toleranz : 25 %

Thrombocytes (G/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex KX21	239	97.5	0.4	2.1	200.9	5.4	e
2	Sysmex PochH - 100i	195	100.0	0.0	0.0	202.3	4.9	e
3	Sysmex XP 300	552	98.5	0.4	1.1	206.8	5.4	e
4	Mythic	284	95.8	2.1	2.1	183.8	10.3	e
5	Swelab	36	100.0	0.0	0.0	192.1	7.5	e
6	Abacus Junior	5	100.0	0.0	0.0	201.0	8.7	e*
7	Medonic	7	100.0	0.0	0.0	186.0	6.0	e
8	Celltac Alpha (Nihon	84	92.8	3.6	3.6	190.9	9.2	e
9	Samsung HC10	33	97.0	3.0	0.0	211.7	8.9	e
10	Micros 60	166	94.6	4.2	1.2	191.3	10.9	e

## Hémoglobine H2



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Z3	44	88.6	2.3	9.1	101.9	4.1	e
2 Abx Micros	144	95.1	3.5	1.4	100.6	3.8	e
3 Microsemi	768	97.5	1.2	1.3	103.8	2.2	e

## Hématocrite H2

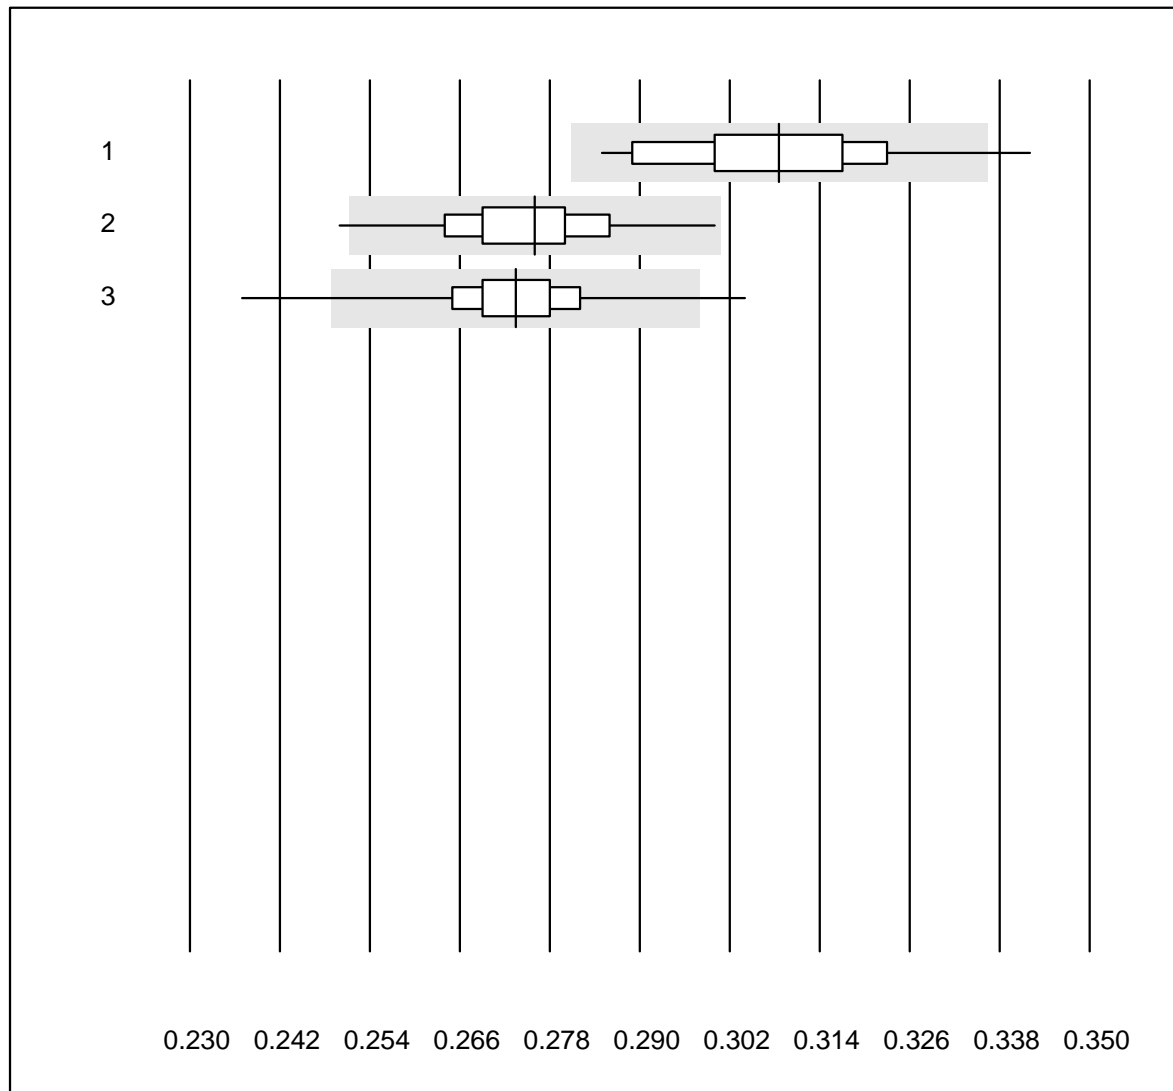


QUALAB Toleranz : 9 %

Hématocrite H2 (l/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Z3	44	84.1	4.5	11.4	0.31	4.2	e
2 Abx Micros	144	95.8	1.4	2.8	0.28	3.5	e
3 Microsemi	766	97.0	1.0	2.0	0.27	2.8	e

## Leucocytes H2

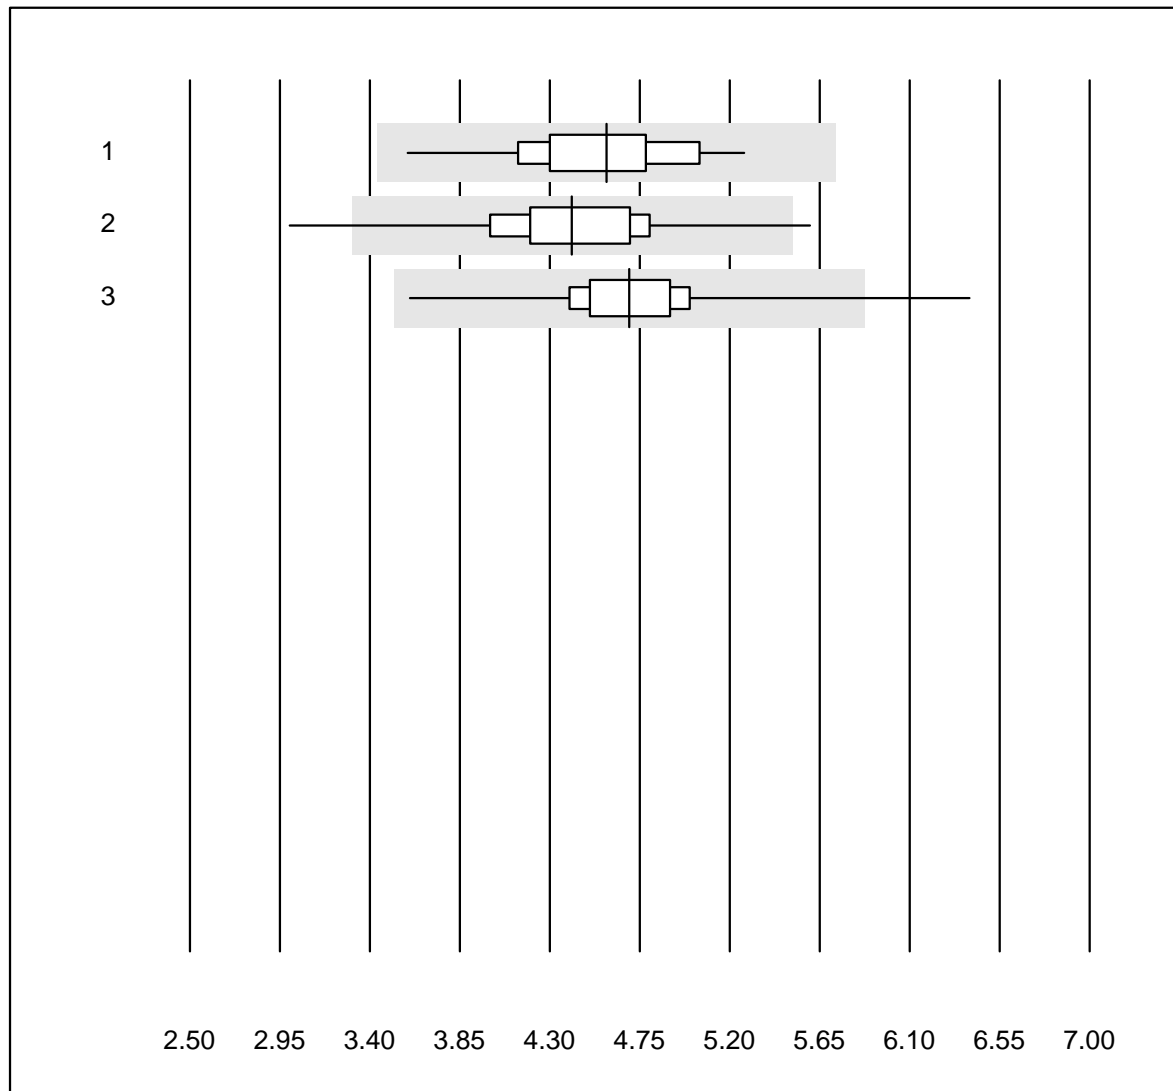


QUALAB Toleranz : 25 %

Leucocytes H2 (G/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Z3	44	100.0	0.0	0.0	4.59	8.0	e
2 Abx Micros	143	98.6	1.4	0.0	4.41	8.2	e
3 Microsemi	767	99.0	0.3	0.7	4.70	5.5	e



## Thrombocytes H2

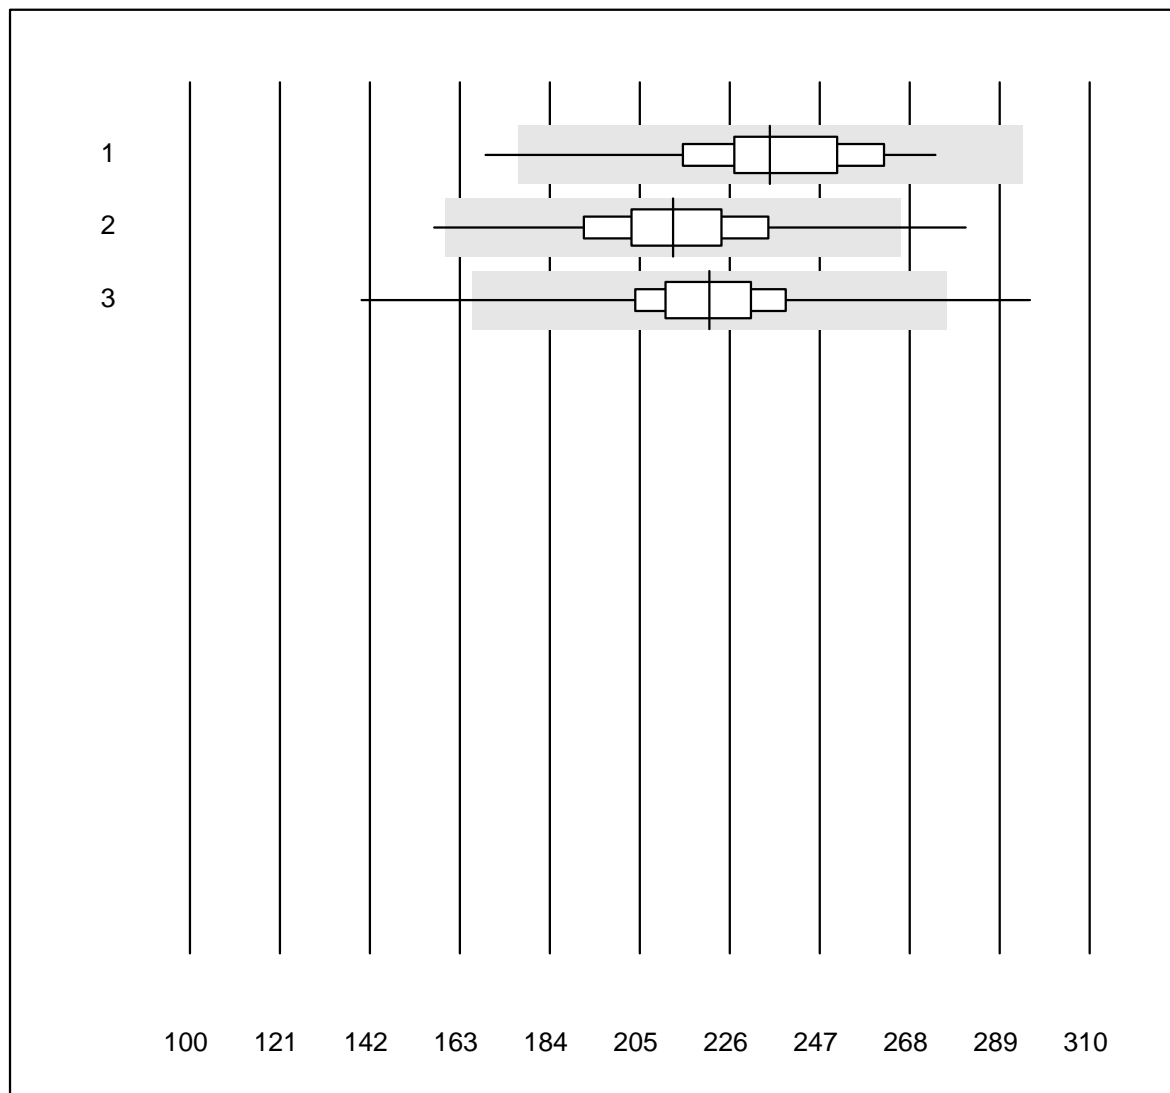


QUALAB Toleranz : 25 %

Thrombocytes H2 (G/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Z3	43	95.4	2.3	2.3	235.4	9.9	e
2 Abx Micros	144	94.4	1.4	4.2	212.7	8.6	e
3 Microsemi	767	98.5	1.0	0.5	221.3	7.2	e

## Erythrocytes H2

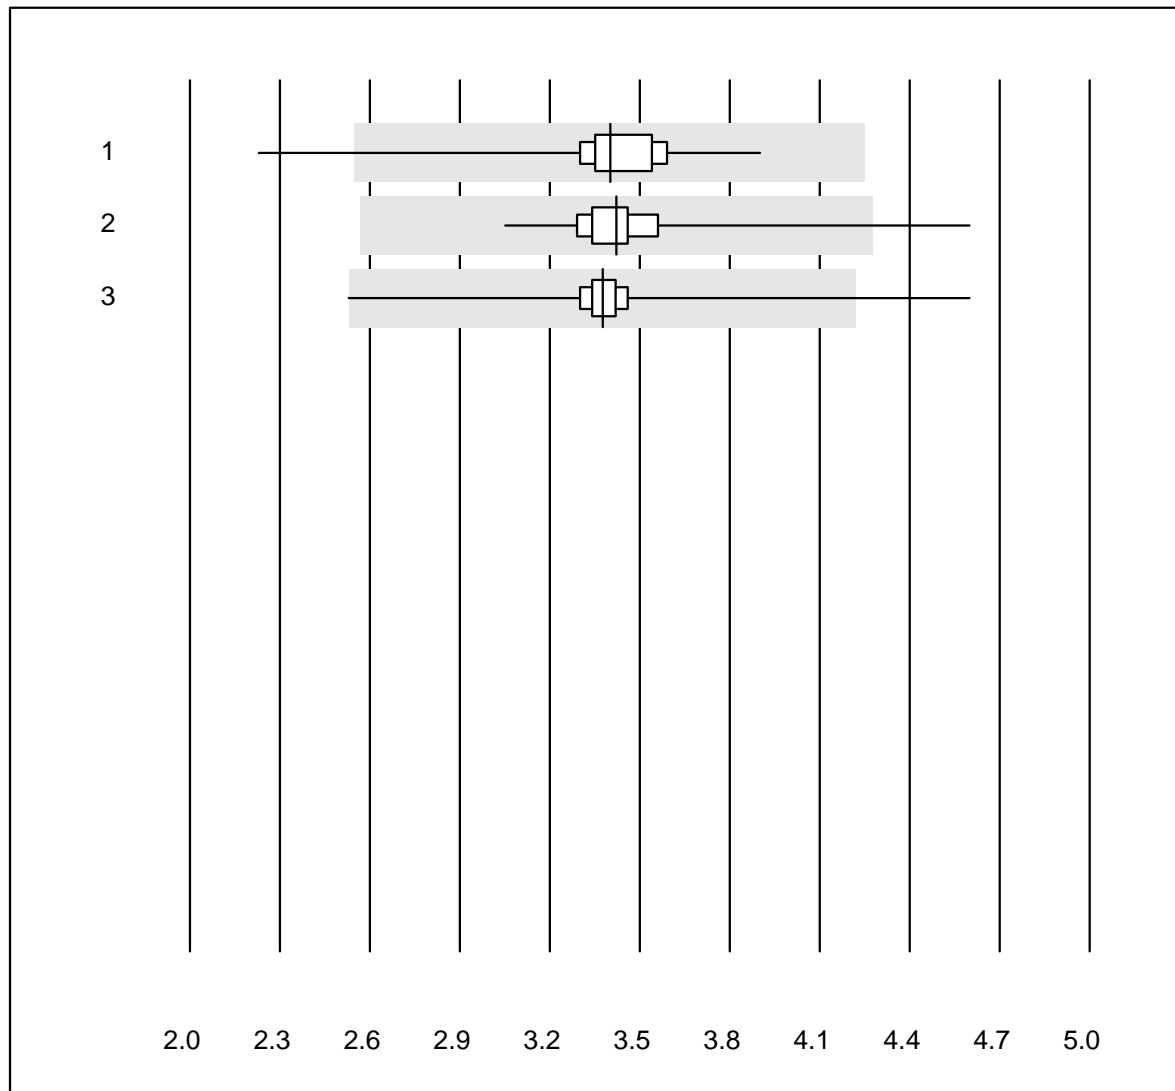


QUALAB Toleranz : 25 %

Erythrocytes H2 (T/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Z3	44	91.0	4.5	4.5	3.40	8.2	e
2 Abx Micros	144	98.6	0.7	0.7	3.42	5.2	e
3 Microsemi	766	98.7	0.4	0.9	3.38	3.5	e

## CRP H2

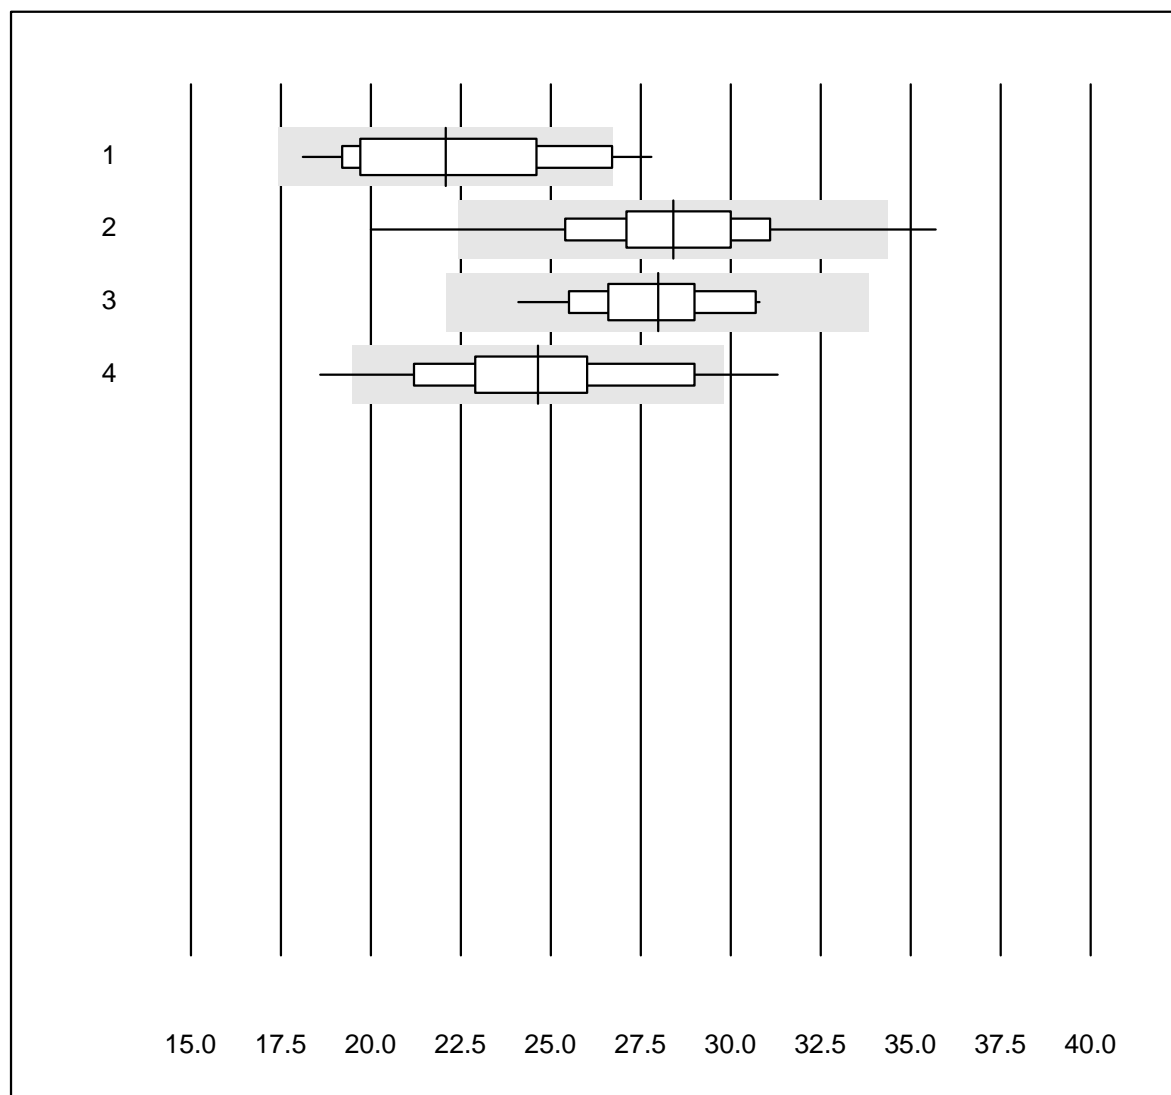


QUALAB Toleranz : 21 %

CRP H2 (mg/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Z3	42	80.9	2.4	16.7	22.1	12.6	e
2 Microsemi	755	96.0	2.1	1.9	28.4	8.3	e
3 Abx Micros	17	94.1	0.0	5.9	28.0	6.6	e
4 ABX Micros CRP200	122	90.9	6.6	2.5	24.6	10.8	e

## Hémoglobine BG

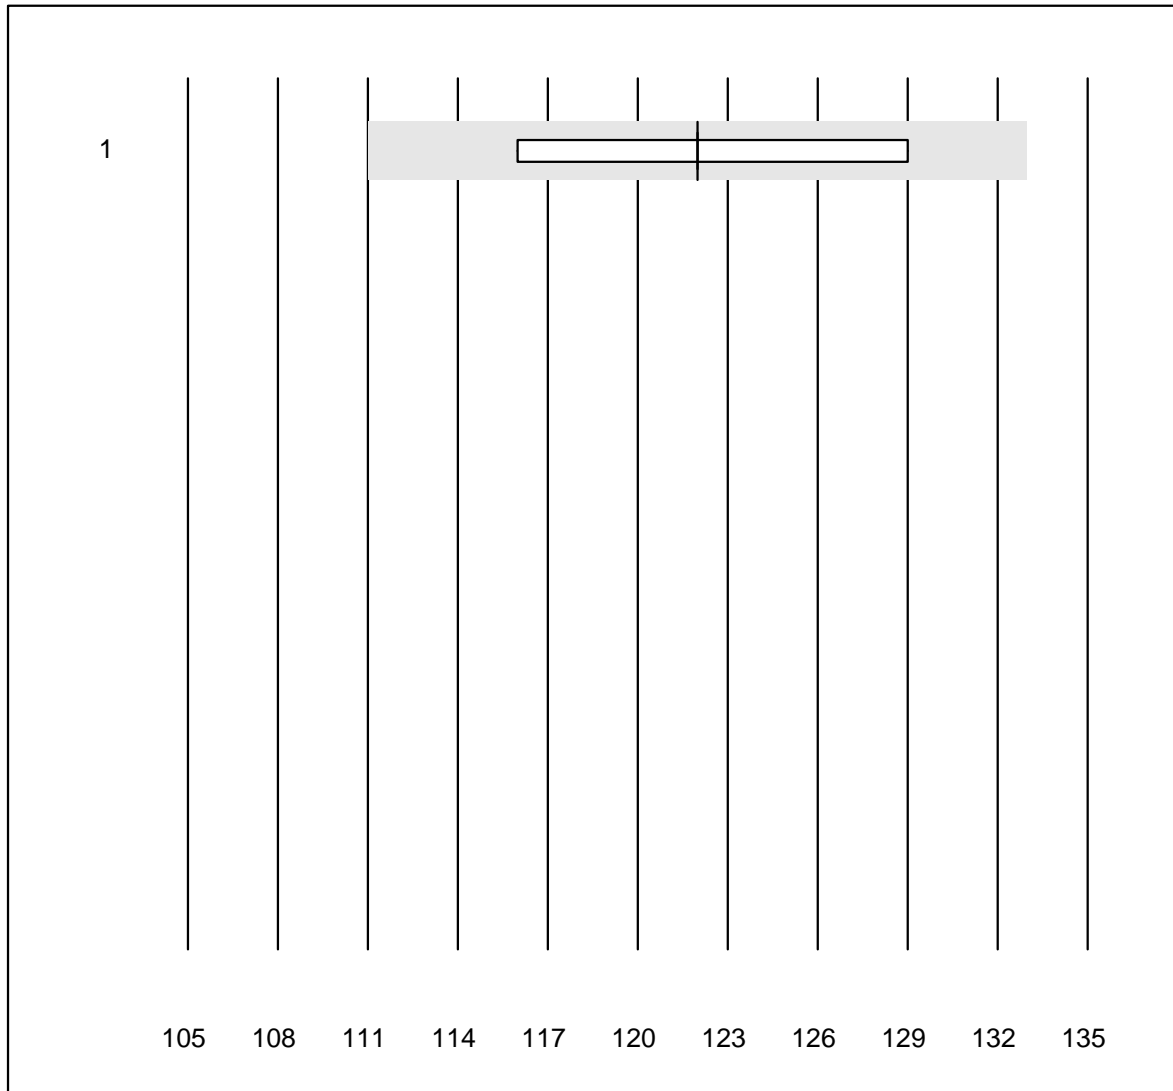


QUALAB Toleranz : 9 %

Hémoglobine BG (g/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 iStat	5	100.0	0.0	0.0	122.0	3.8	e*

## Hématocrite

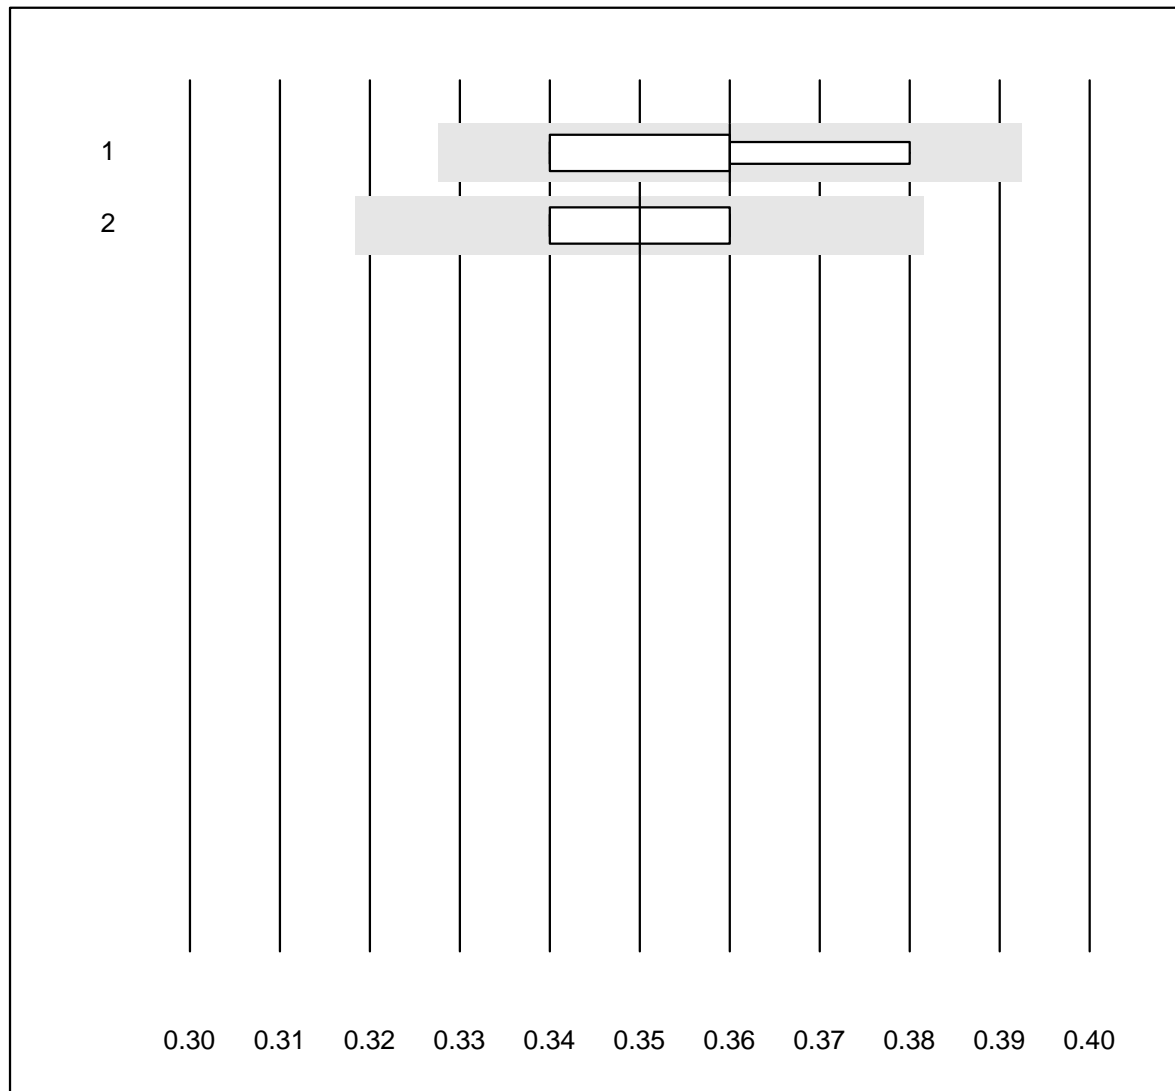


QUALAB Toleranz : 9 %

Hématocrite (l/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 iStat	7	100.0	0.0	0.0	0.36	3.9	e*
2 EPOC	8	87.5	0.0	12.5	0.35	2.3	e

## Hémoglobine

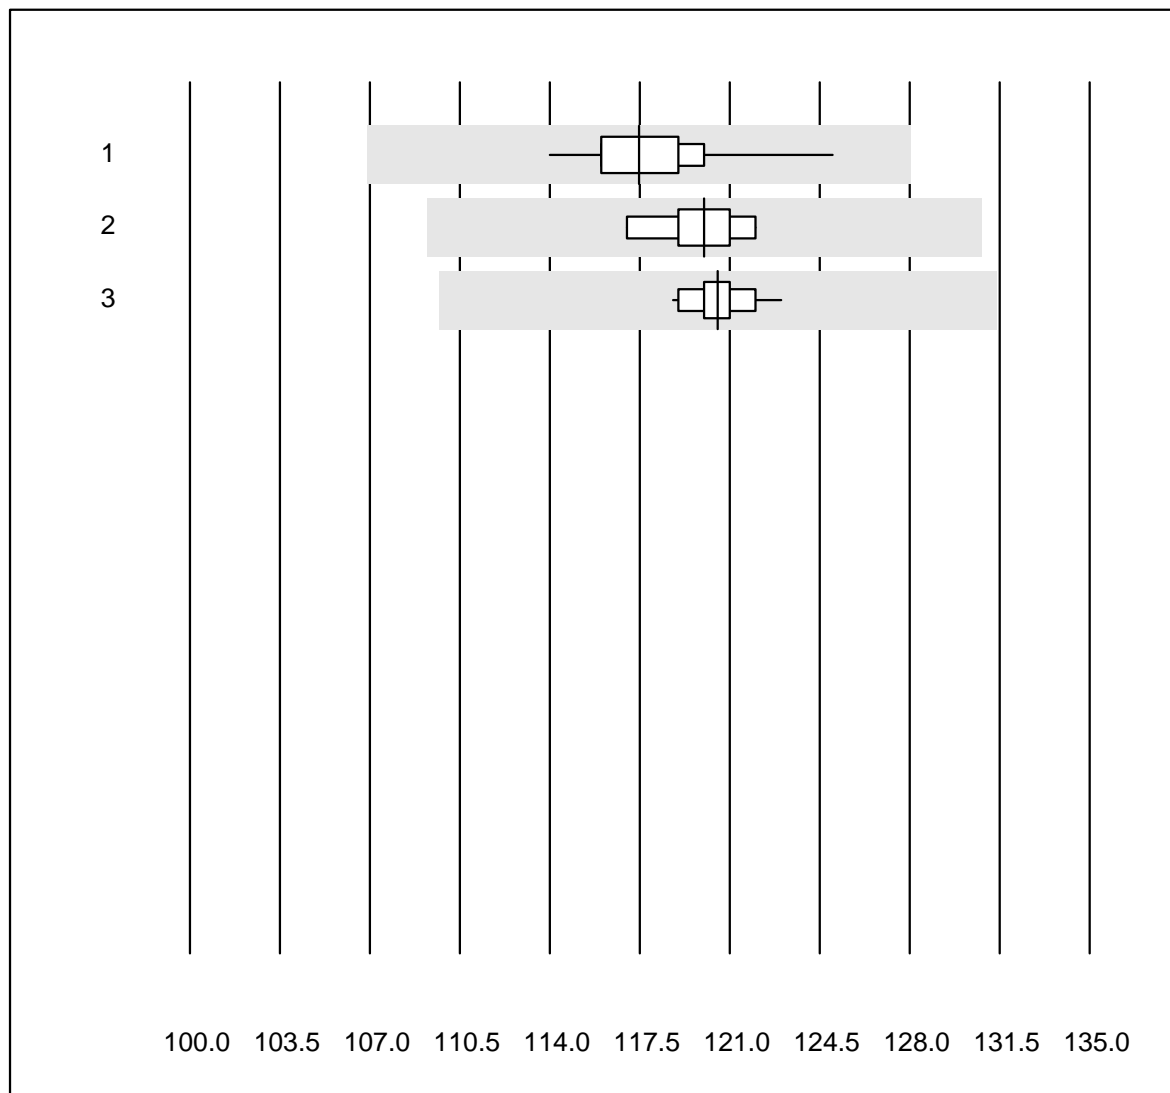


QUALAB Toleranz : 9 %

Hémoglobine (g/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	70	98.6	0.0	1.4	117.5	1.5	e
2 Advia	5	100.0	0.0	0.0	120.0	1.6	e
3 Yumizen/Pentra	11	100.0	0.0	0.0	120.5	1.0	e

## Hématocrite

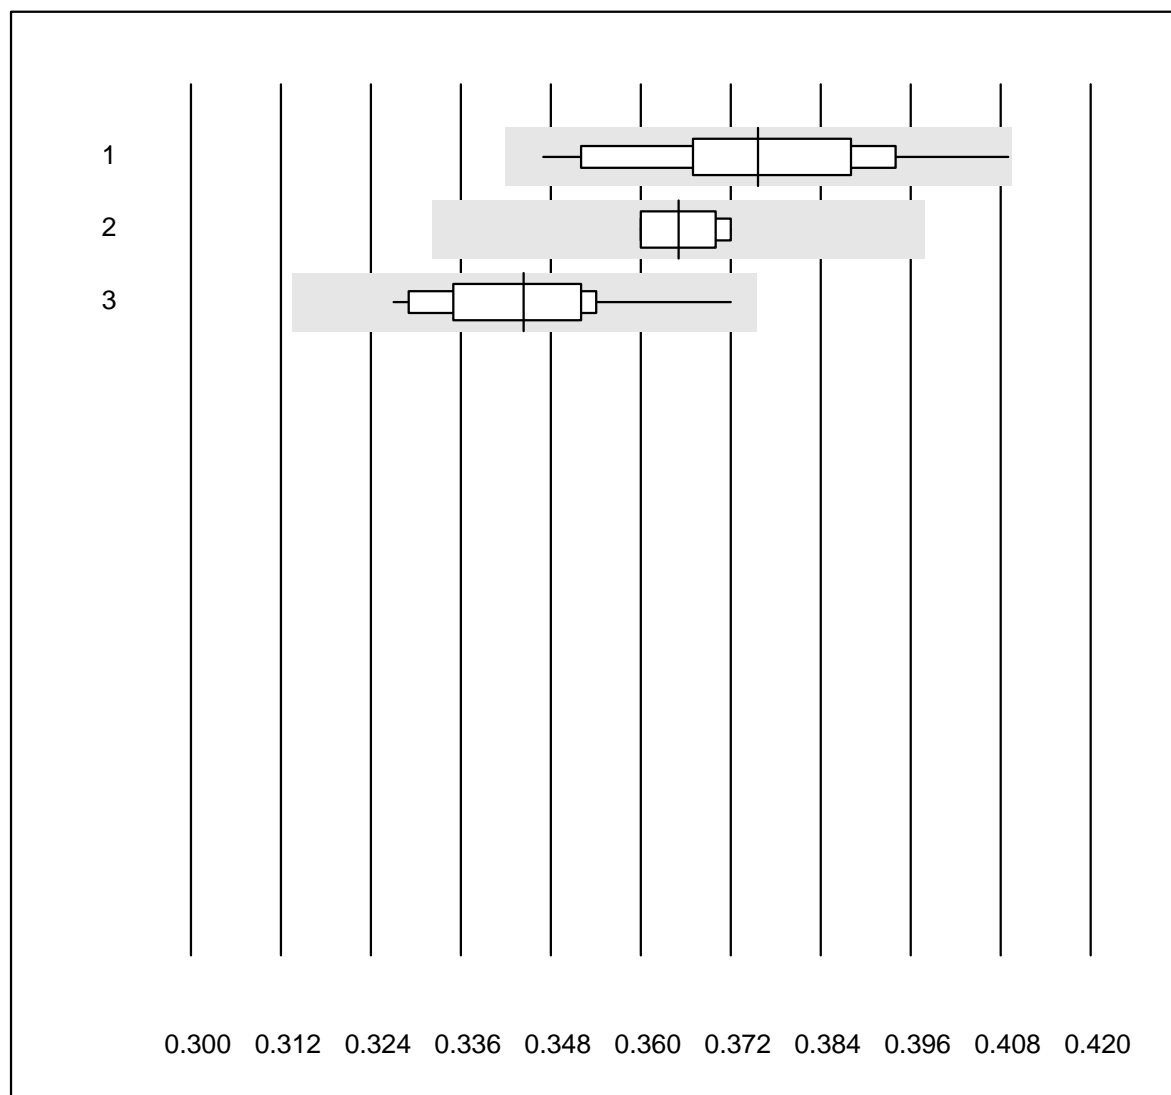


QUALAB Toleranz : 9 %

Hématocrite (l/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	70	100.0	0.0	0.0	0.38	4.0	e
2 Advia	5	100.0	0.0	0.0	0.37	1.5	e
3 Yumizen/Pentra	11	100.0	0.0	0.0	0.34	3.7	e*

# Erythrocytes

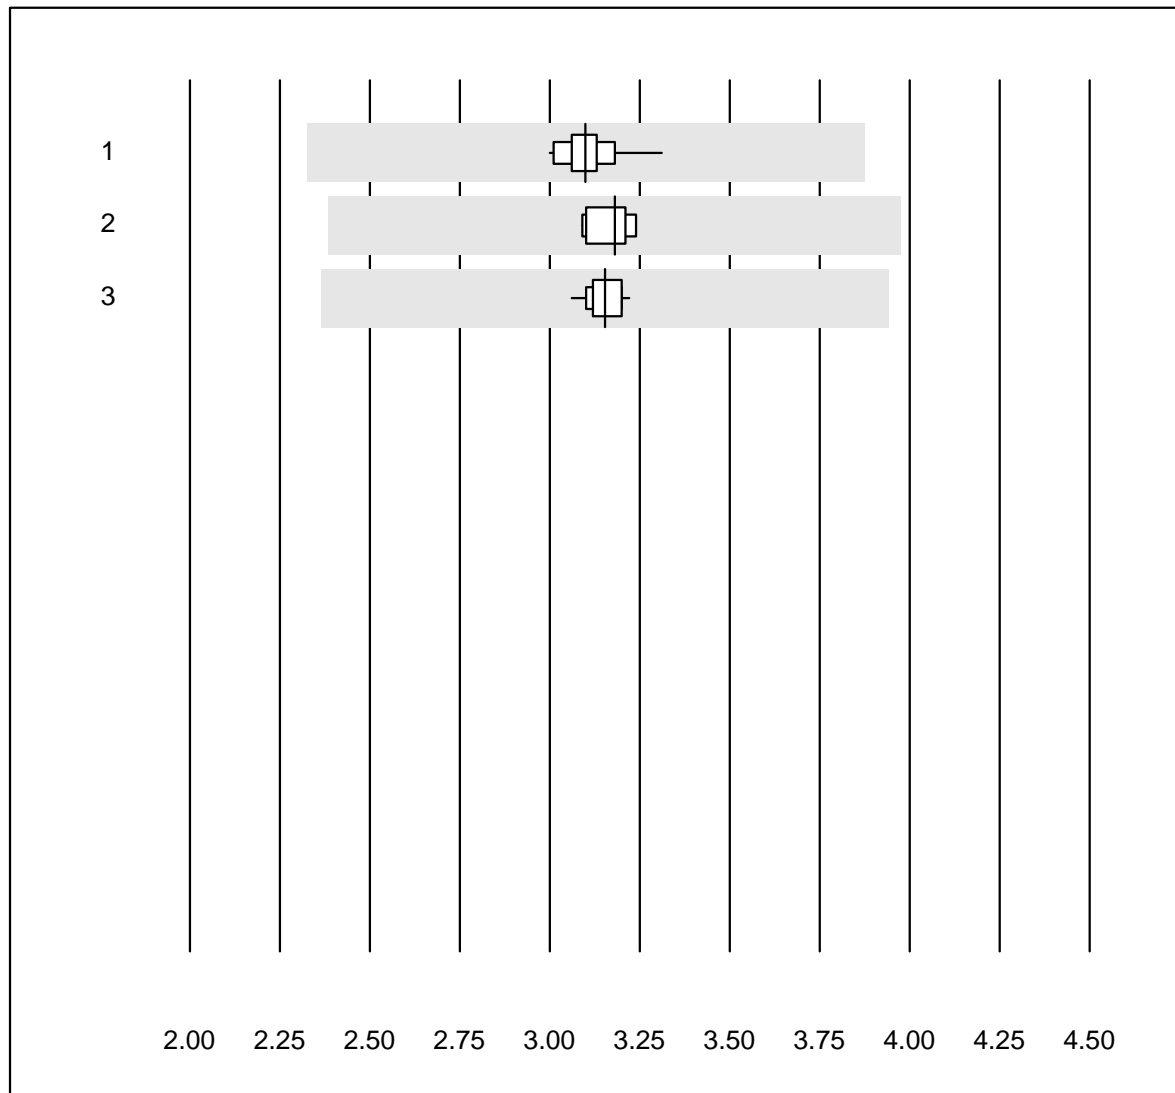


QUALAB Toleranz : 25 %

Erythrocytes (T/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex	70	100.0	0.0	0.0	3.10	2.0	e
2	Advia	5	100.0	0.0	0.0	3.18	2.1	e
3	Yumizen/Pentra	11	100.0	0.0	0.0	3.15	1.5	e



## Leucocytes

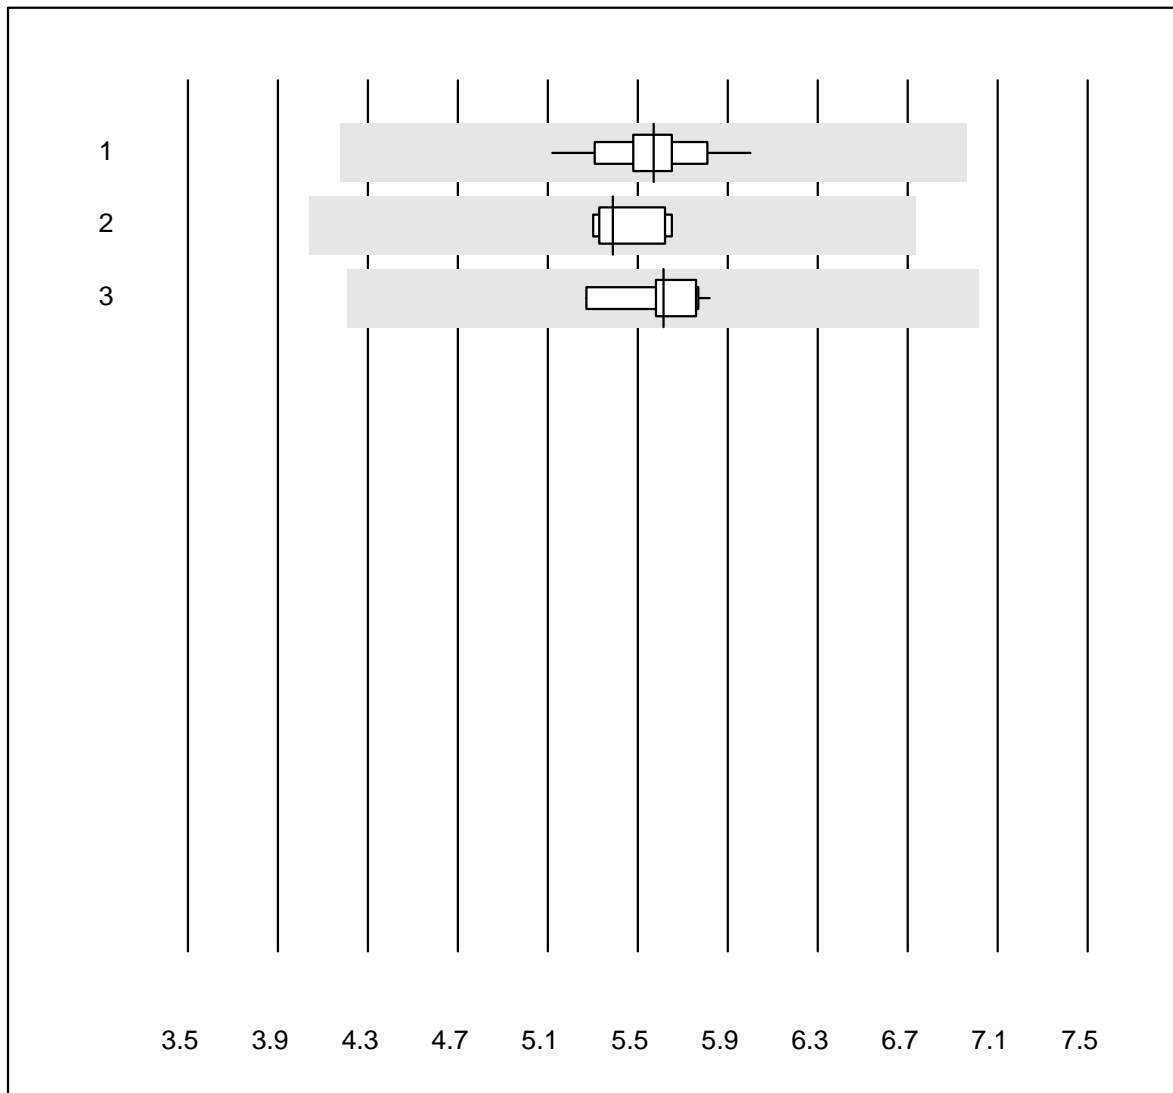


QUALAB Toleranz : 25 %

Leucocytes (G/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	69	100.0	0.0	0.0	5.57	3.3	e
2 Advia	5	100.0	0.0	0.0	5.39	3.0	e
3 Yumizen/Pentra	11	90.9	0.0	9.1	5.61	3.4	e

## Thrombocytes

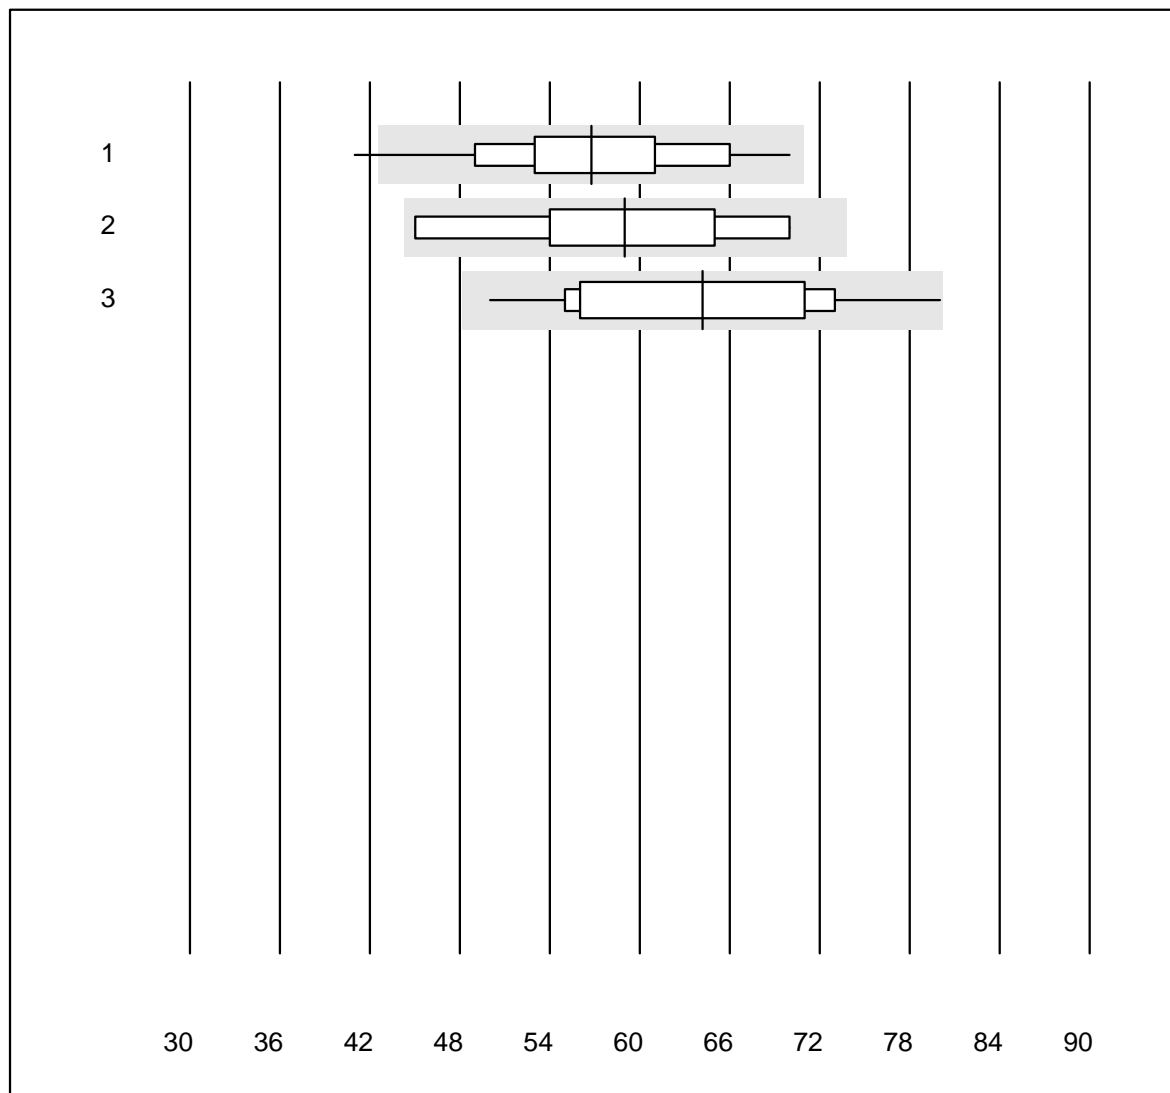


QUALAB Toleranz : 25 %

Thrombocytes (G/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	68	94.2	2.9	2.9	56.8	11.5	e
2 Advia	5	100.0	0.0	0.0	59.0	16.6	e*
3 Yumizen/Pentra	11	100.0	0.0	0.0	64.2	13.8	e*

## Neutrophiles

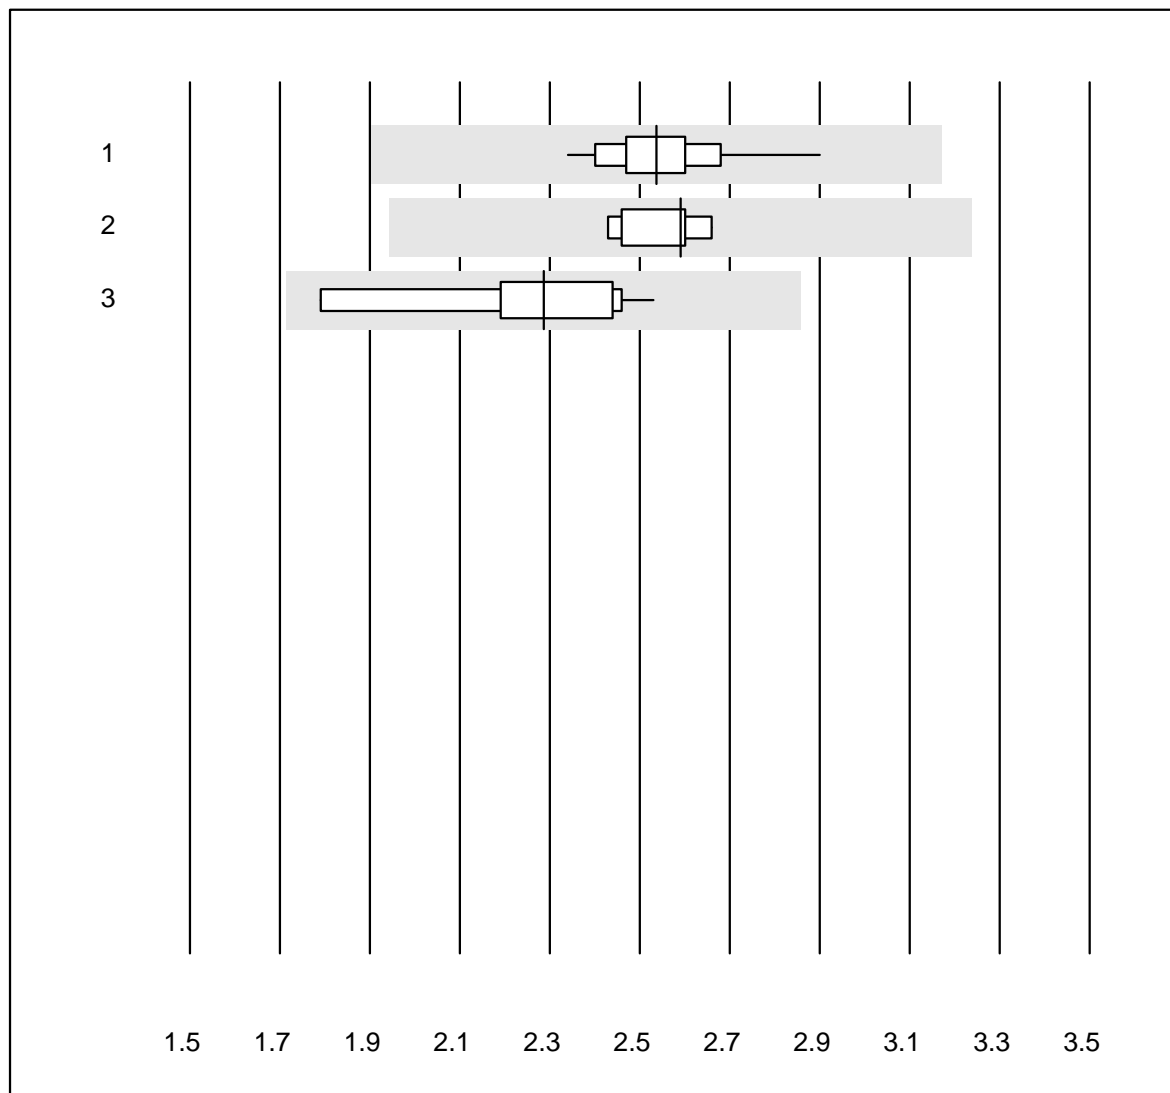


Tolérance MQ : 25 %

Neutrophiles (G/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	69	100.0	0.0	0.0	2.54	4.3	e
2 Advia	5	100.0	0.0	0.0	2.59	3.9	e
3 Yumizen/Pentra	11	90.9	0.0	9.1	2.29	9.5	e

## Lymphocytes

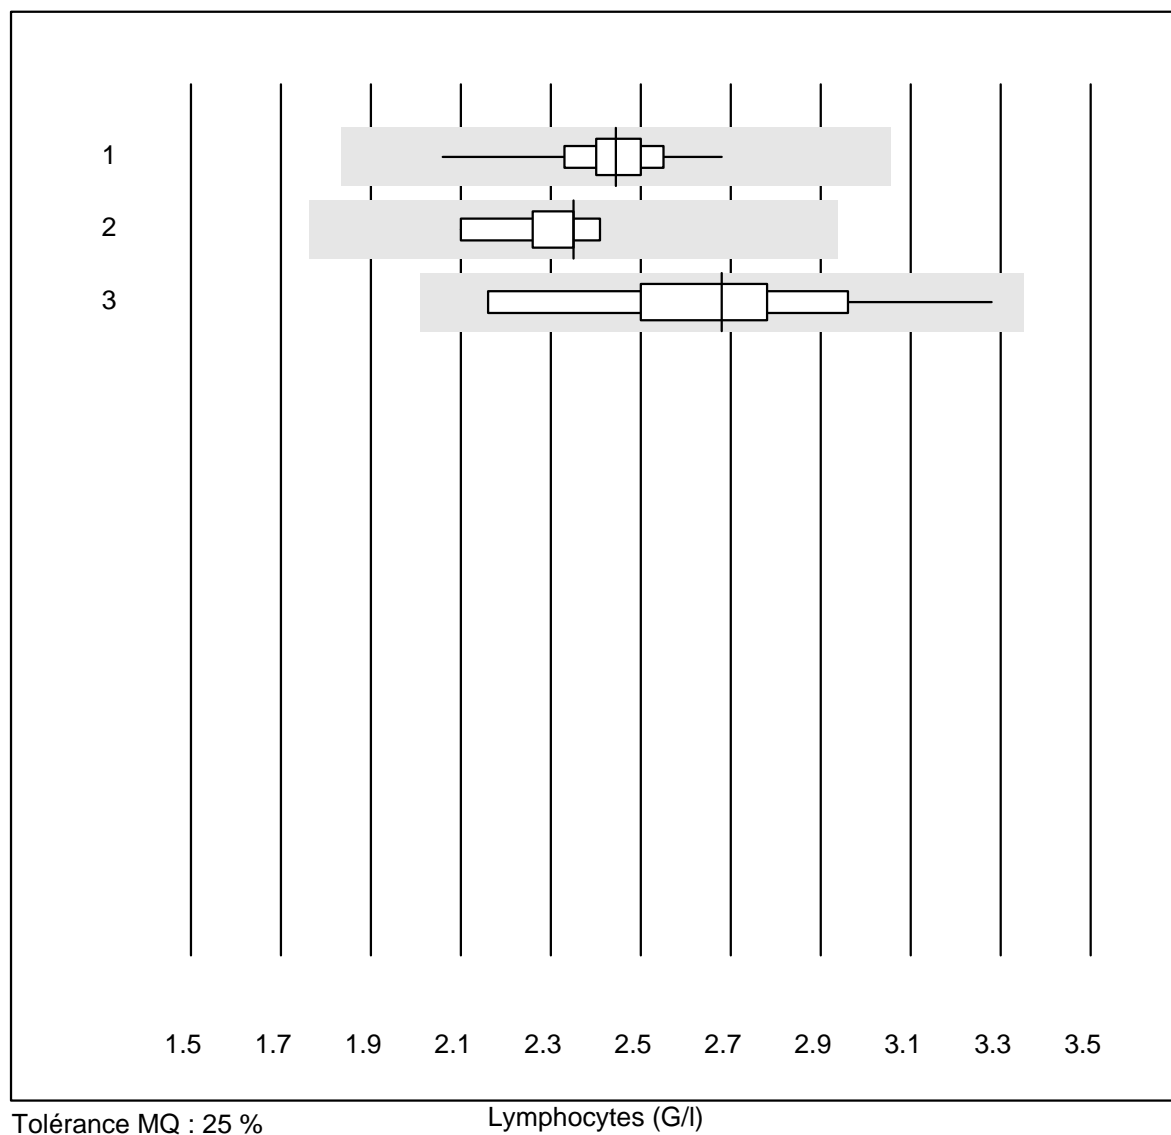


Tolérance MQ : 25 %

Lymphocytes (G/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex	69	100.0	0.0	0.0	2.45	4.6	e
2	Advia	5	100.0	0.0	0.0	2.35	5.3	e
3	Yumizen/Pentra	11	90.9	0.0	9.1	2.68	11.2	e*

## Monocytes

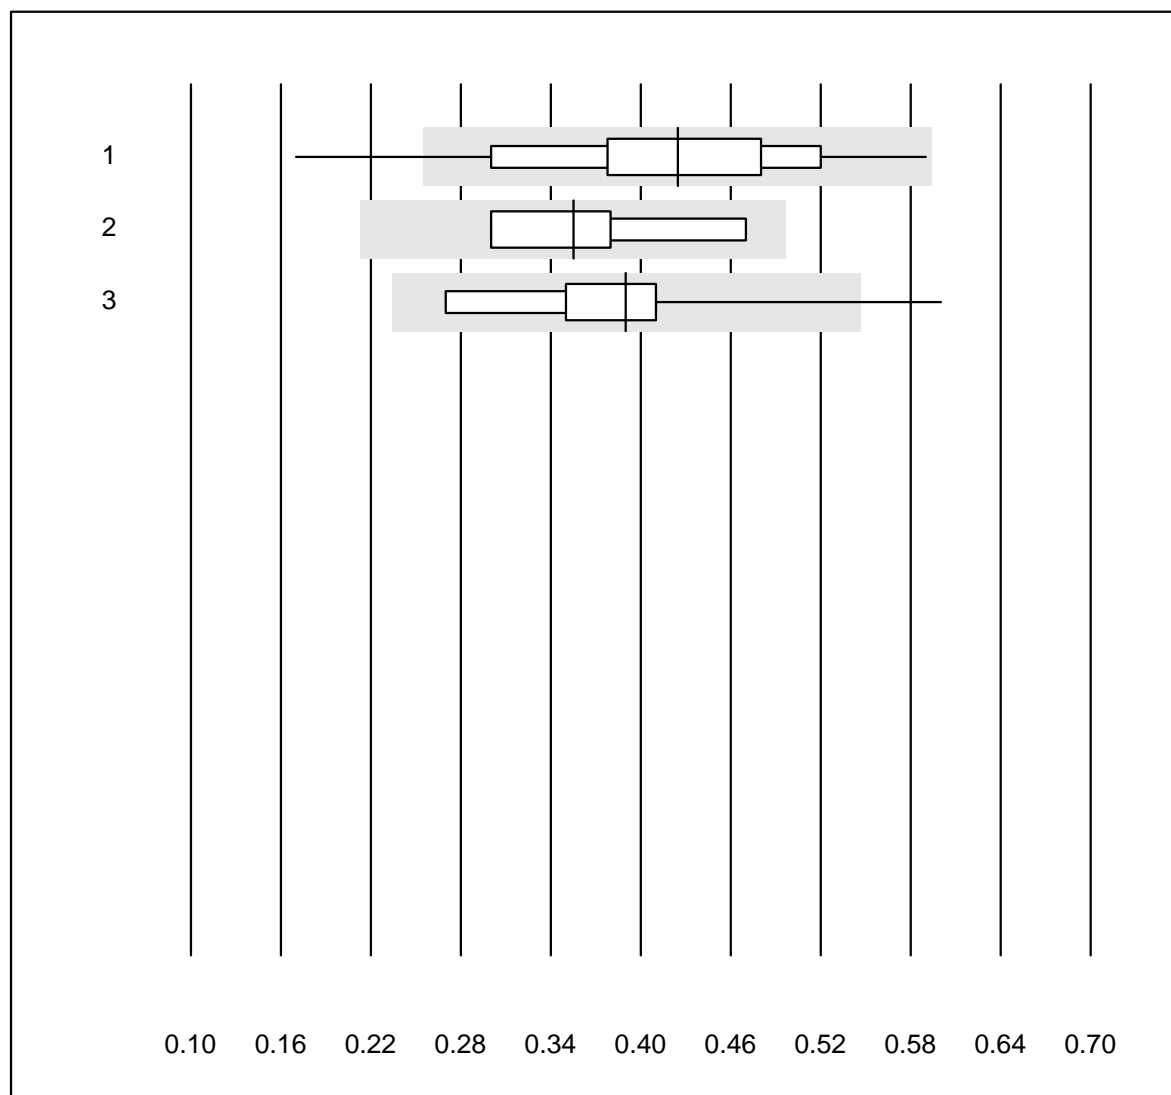


Tolérance MQ : 40 %

Monocytes (G/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	69	94.2	5.8	0.0	0.42	20.8	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	0.36	20.1	e*
3 Yumizen/Pentra	11	81.8	9.1	9.1	0.39	22.3	e*

## Eosinophiles

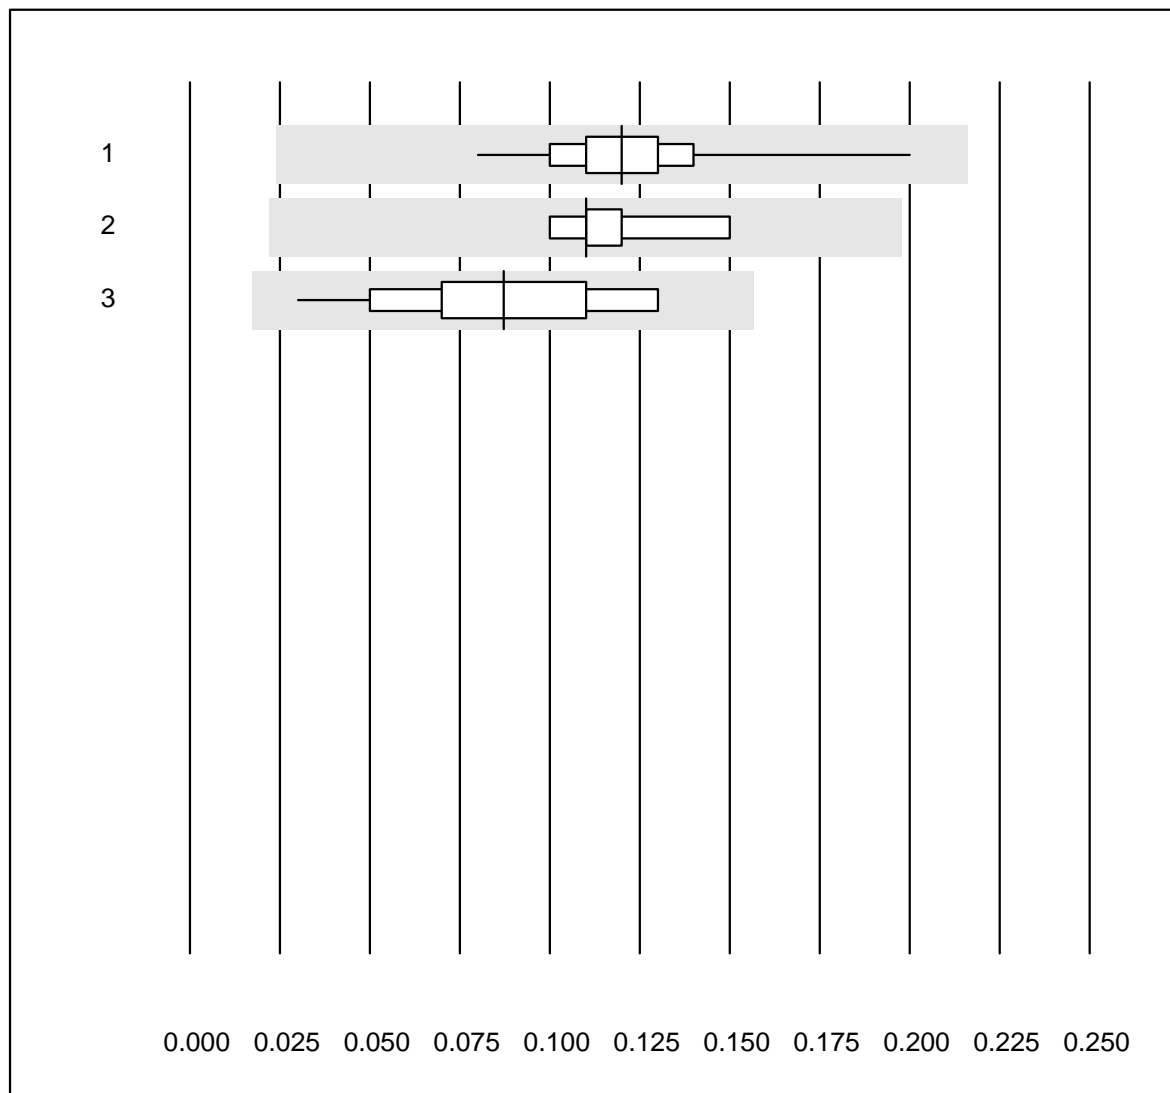


Tolérance MQ : 80 %

Eosinophiles (G/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	69	100.0	0.0	0.0	0.12	14.4	a
2 Advia	5	100.0	0.0	0.0	0.11	16.3	e
3 Yumizen/Pentra	11	100.0	0.0	0.0	0.09	35.1	e*

## Basophiles

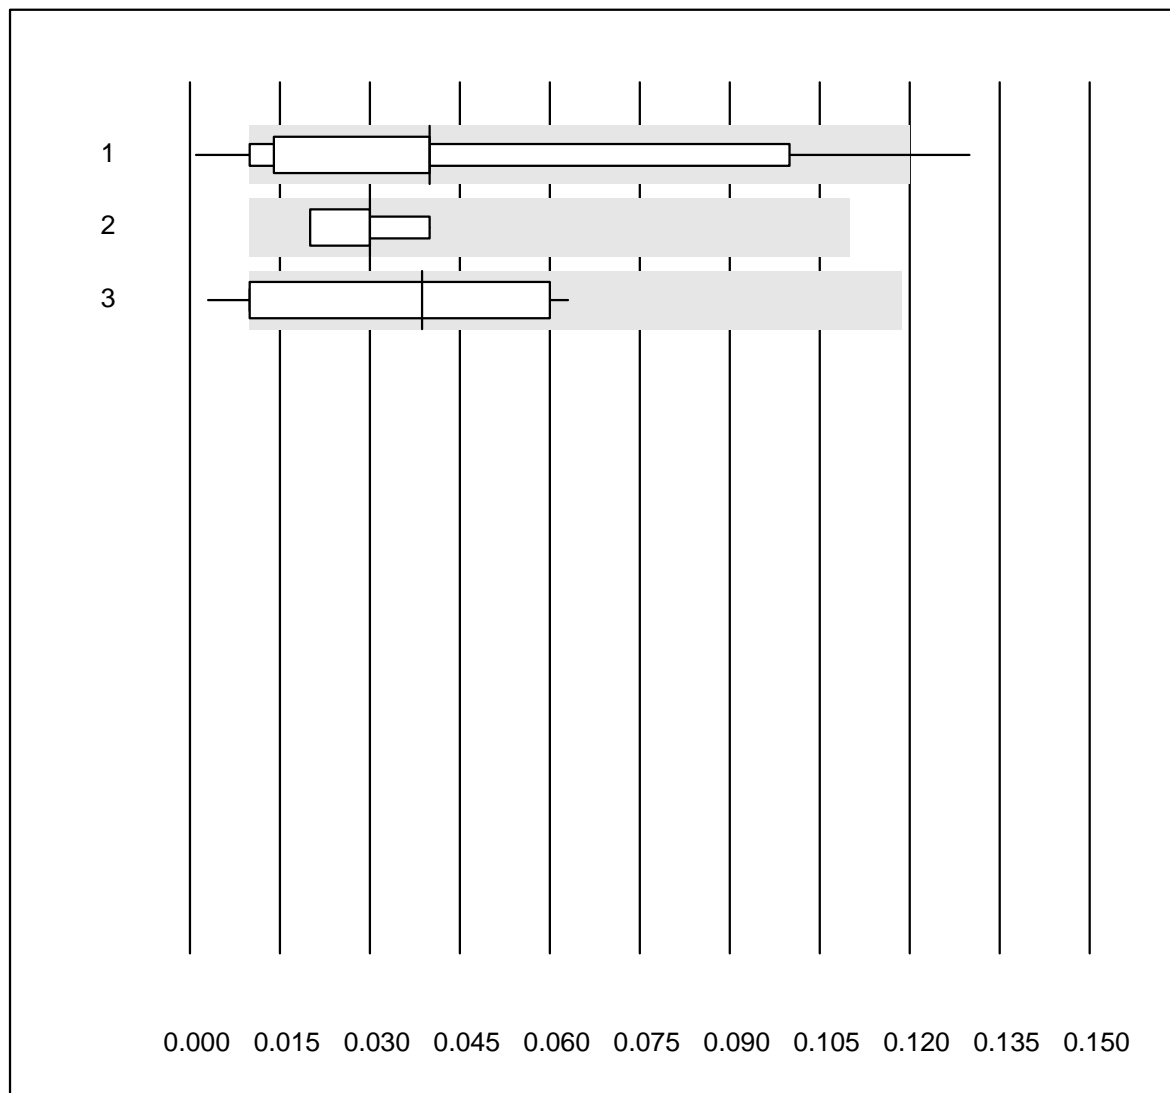


Tolérance MQ : 80 %  
 (< 0.10: +/- 0.08 G/l)

Basophiles (G/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	67	94.0	6.0	0.0	0.04	90.0	a
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	0.03	27.2	e*
3 Yumizen/Pentra	11	100.0	0.0	0.0	0.04	60.4	e*

# MCV

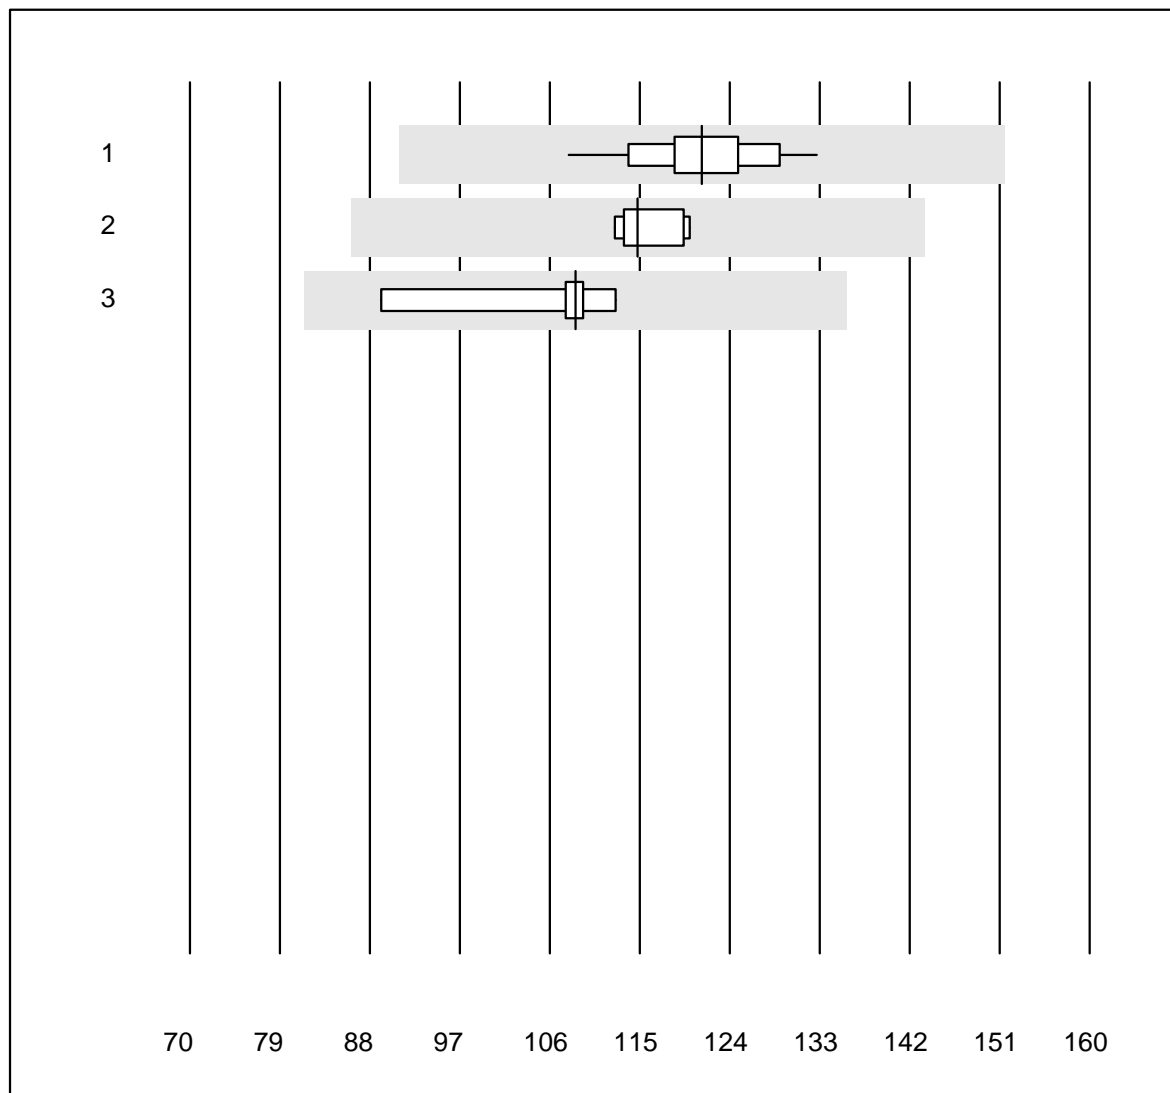


Tolérance MQ : 25 %

MCV (fl)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	63	100.0	0.0	0.0	121.2	4.9	e
2 Advia	5	100.0	0.0	0.0	114.8	3.0	e
3 Yumizen/Pentra	9	100.0	0.0	0.0	108.6	6.6	e



# MCH

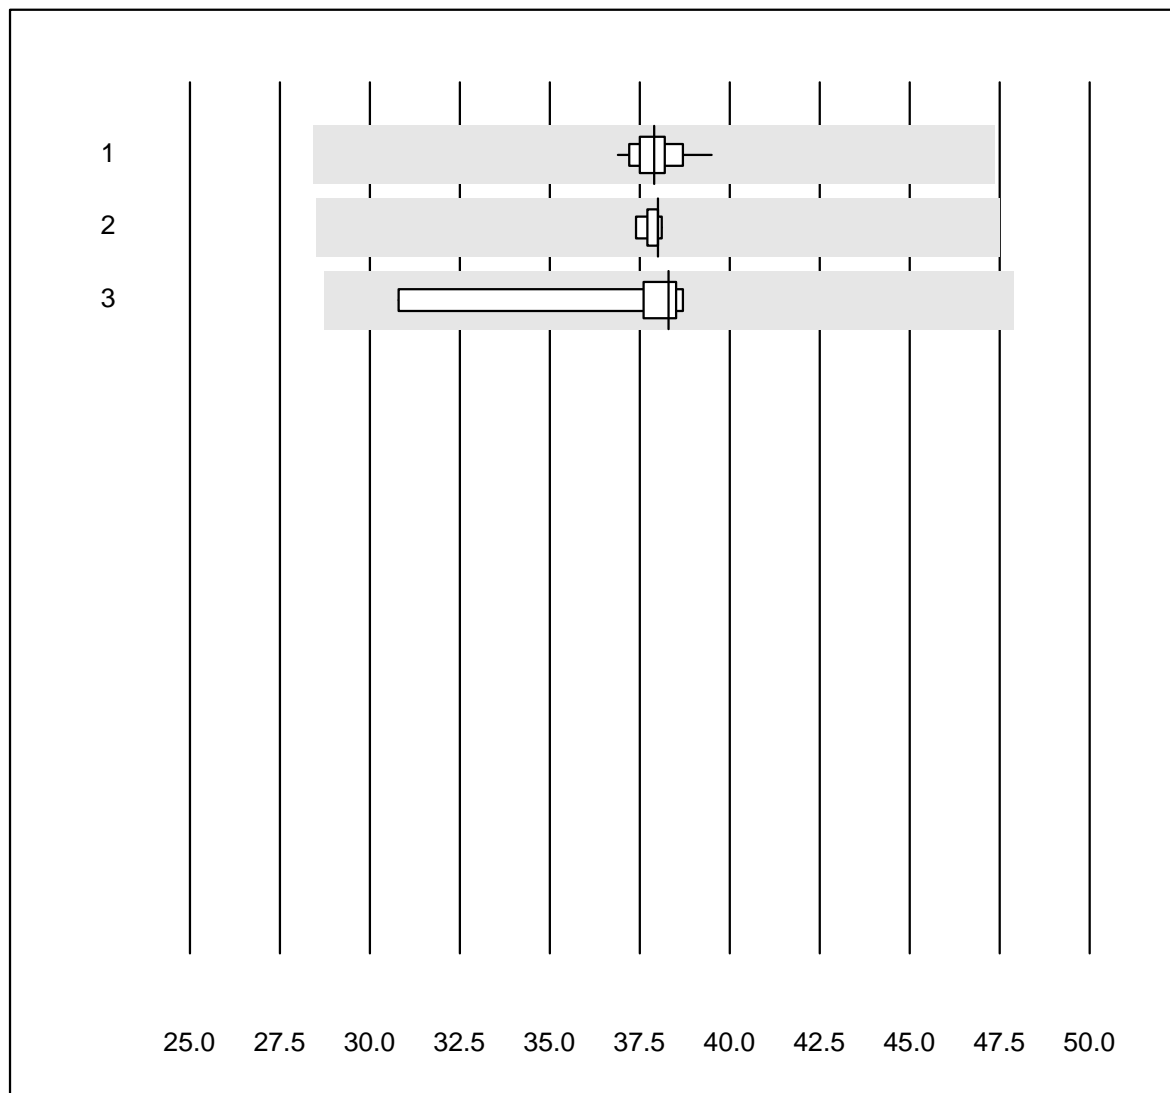


Tolérance MQ : 25 %

MCH (pg)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	62	100.0	0.0	0.0	37.9	1.5	e
2 Advia	5	100.0	0.0	0.0	38.0	0.8	e
3 Yumizen/Pentra	9	100.0	0.0	0.0	38.3	6.7	e

# MCHC

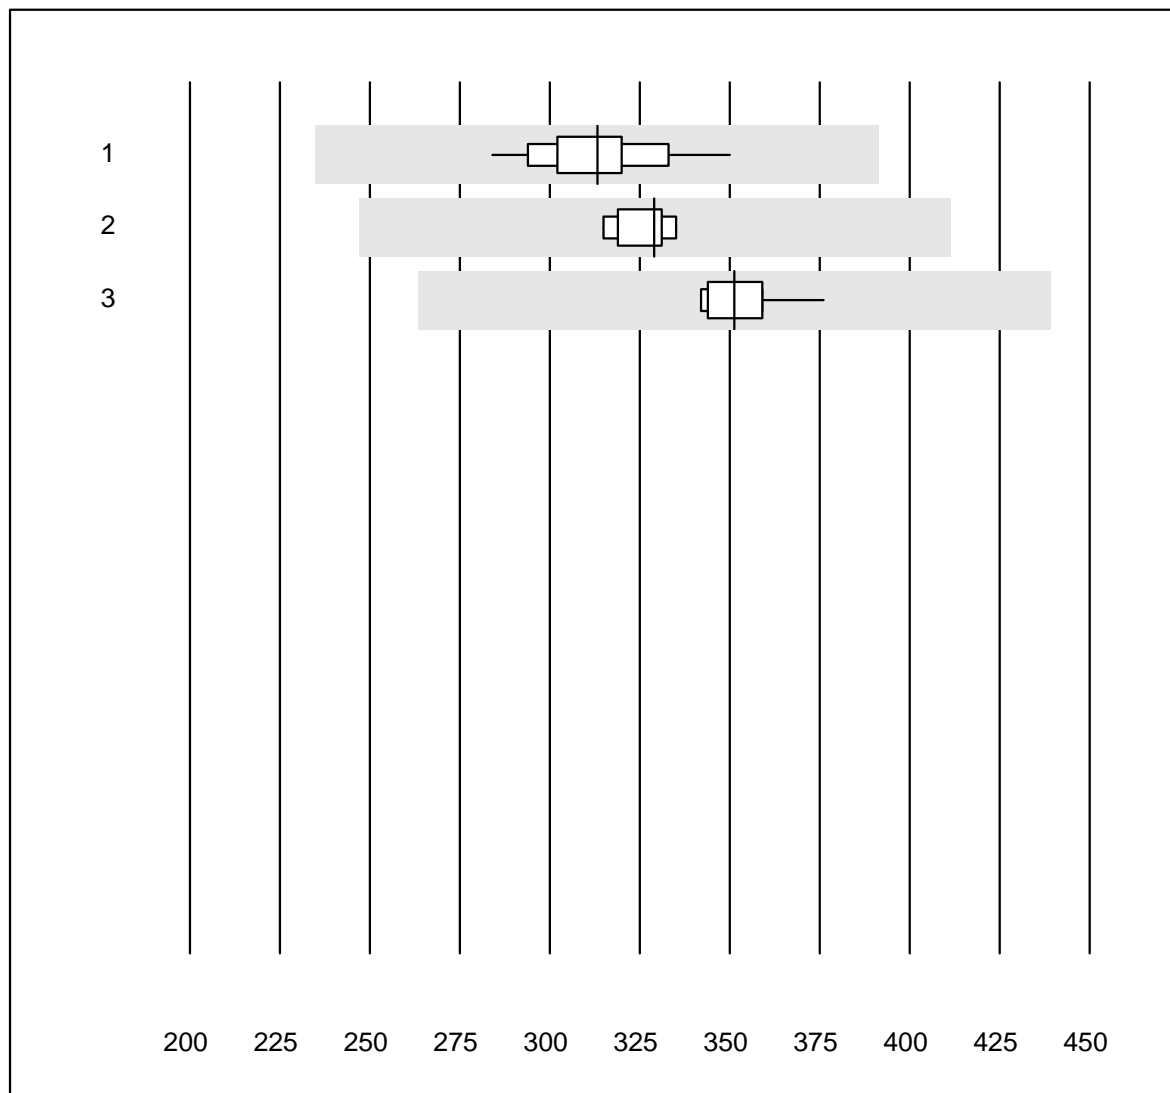


Tolérance MQ : 25 %

MCHC (g/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	63	100.0	0.0	0.0	313	4.8	e
2 Advia	5	100.0	0.0	0.0	329	2.6	e
3 Yumizen/Pentra	10	100.0	0.0	0.0	351	3.1	e

## RDW

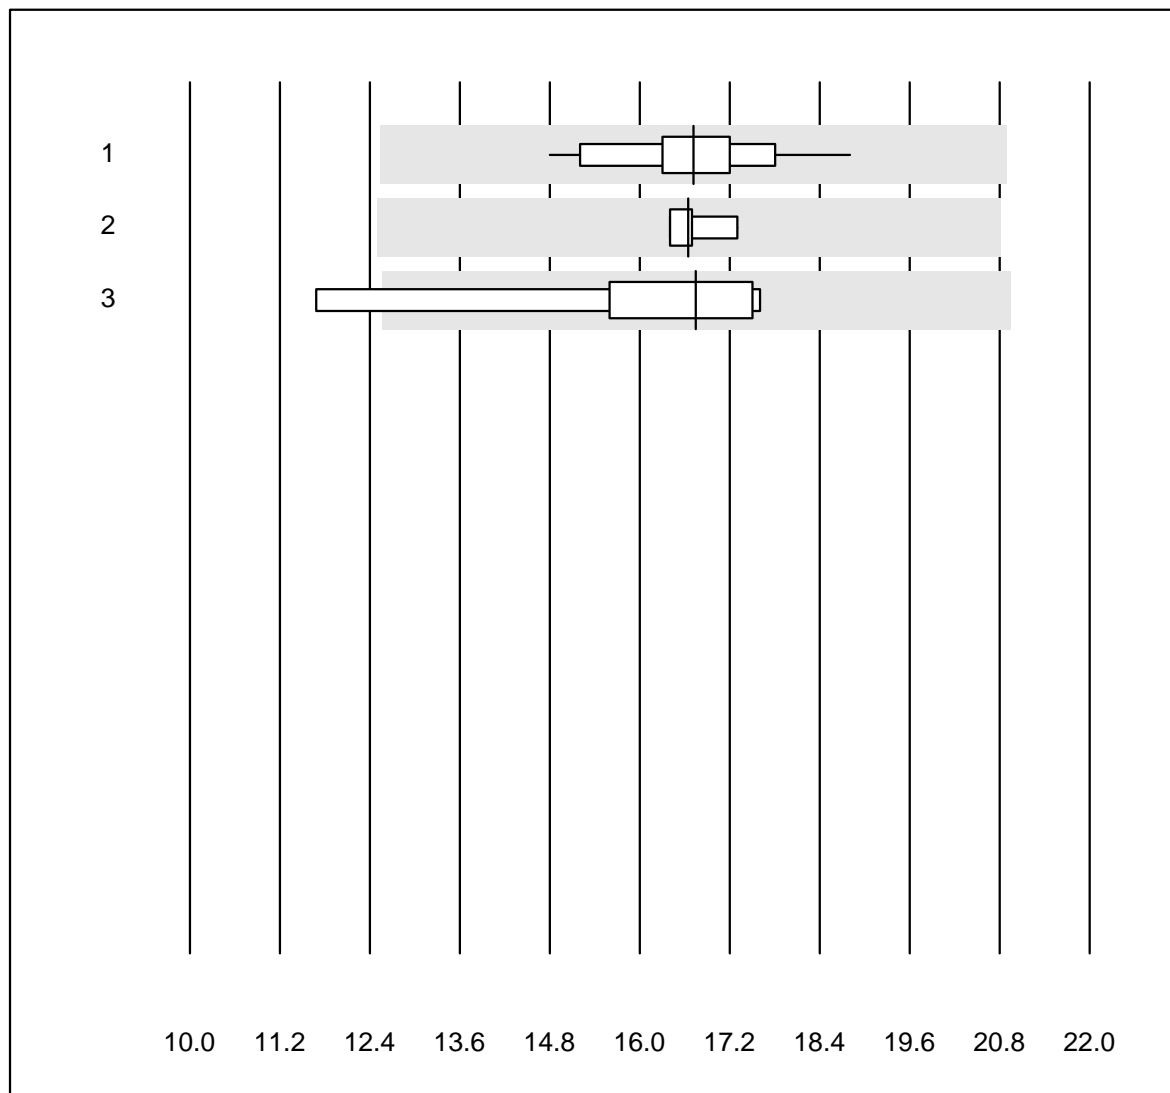


Tolérance MQ : 25 %

RDW (%)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	62	95.2	0.0	4.8	16.7	5.2	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	16.7	2.3	e
3 Yumizen/Pentra	8	75.0	12.5	12.5	16.8	13.0	e*

## Immature Granulocytes

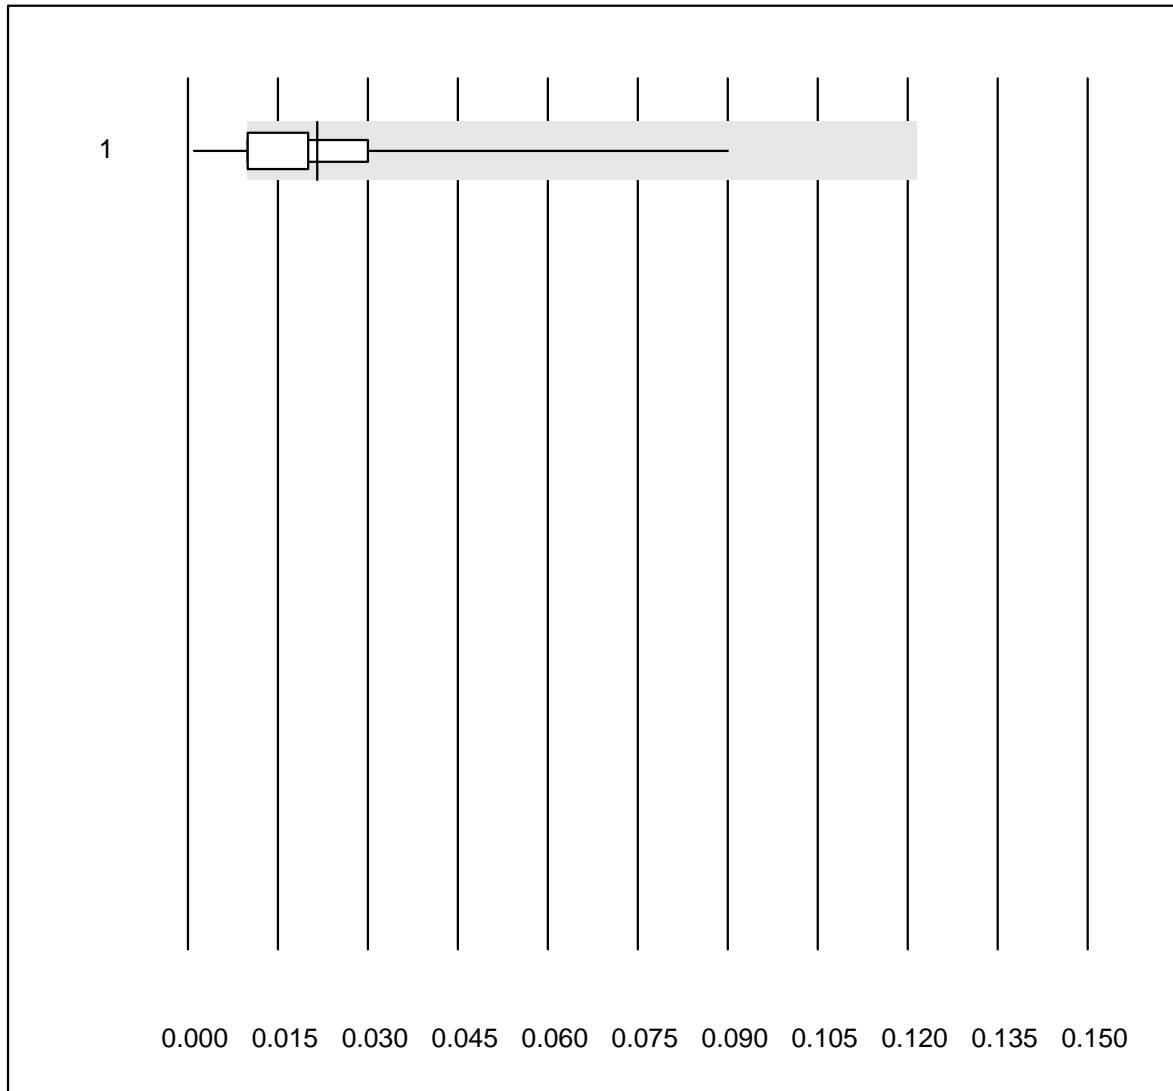


Tolérance MQ : 25 %  
 (< 0.10: +/- 0.10 G/l)

Immature Granulocytes (G/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex	54	100.0	0.0	0.0	0.02	77.3	e*

## Réticulocytes

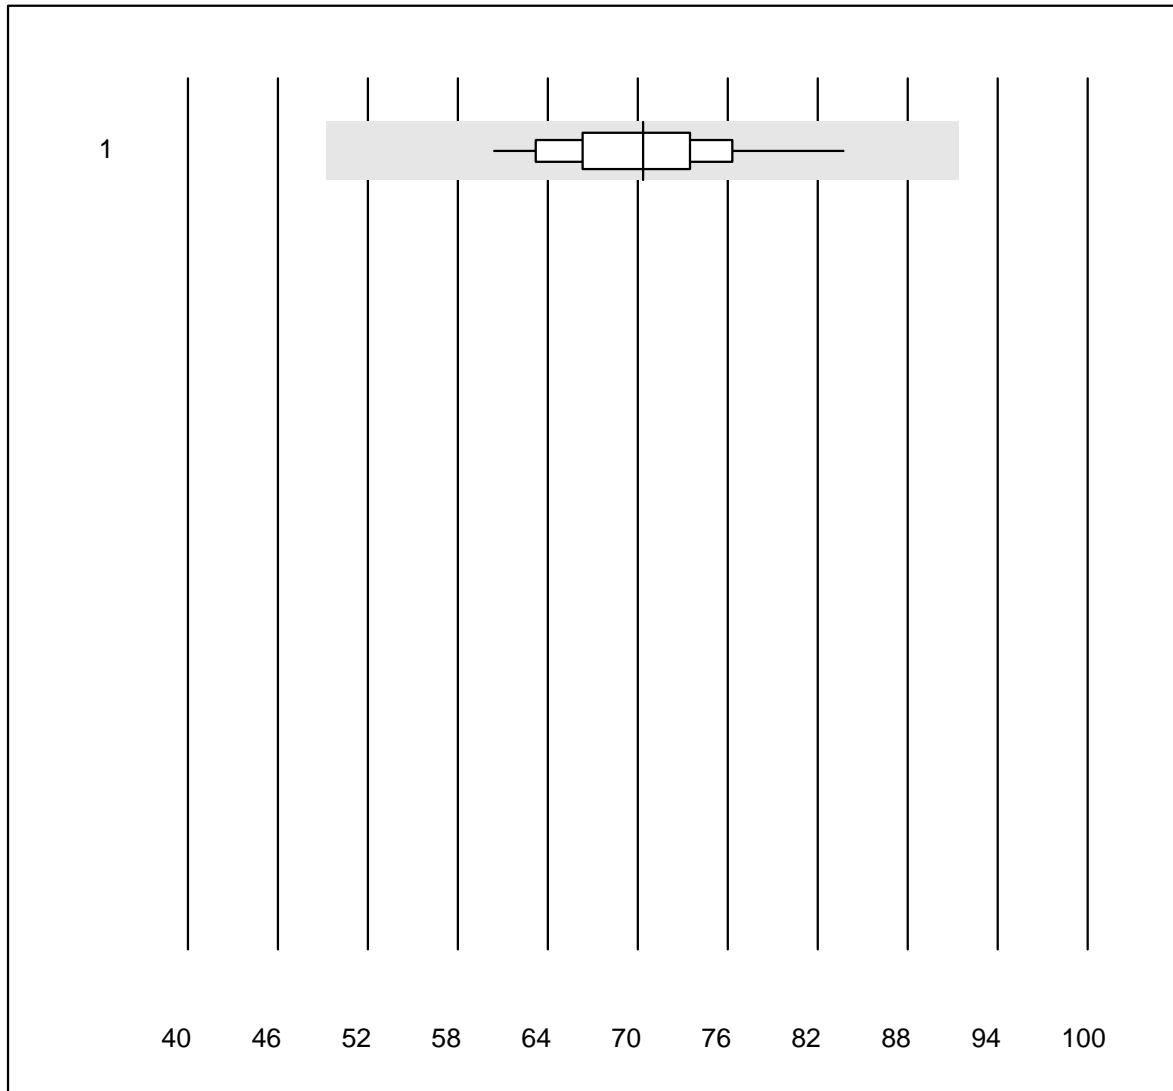


Tolérance MQ : 30 %

Réticulocytes (G/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	36	100.0	0.0	0.0	70.3	7.5	e

## Index hémolytique échantillon A

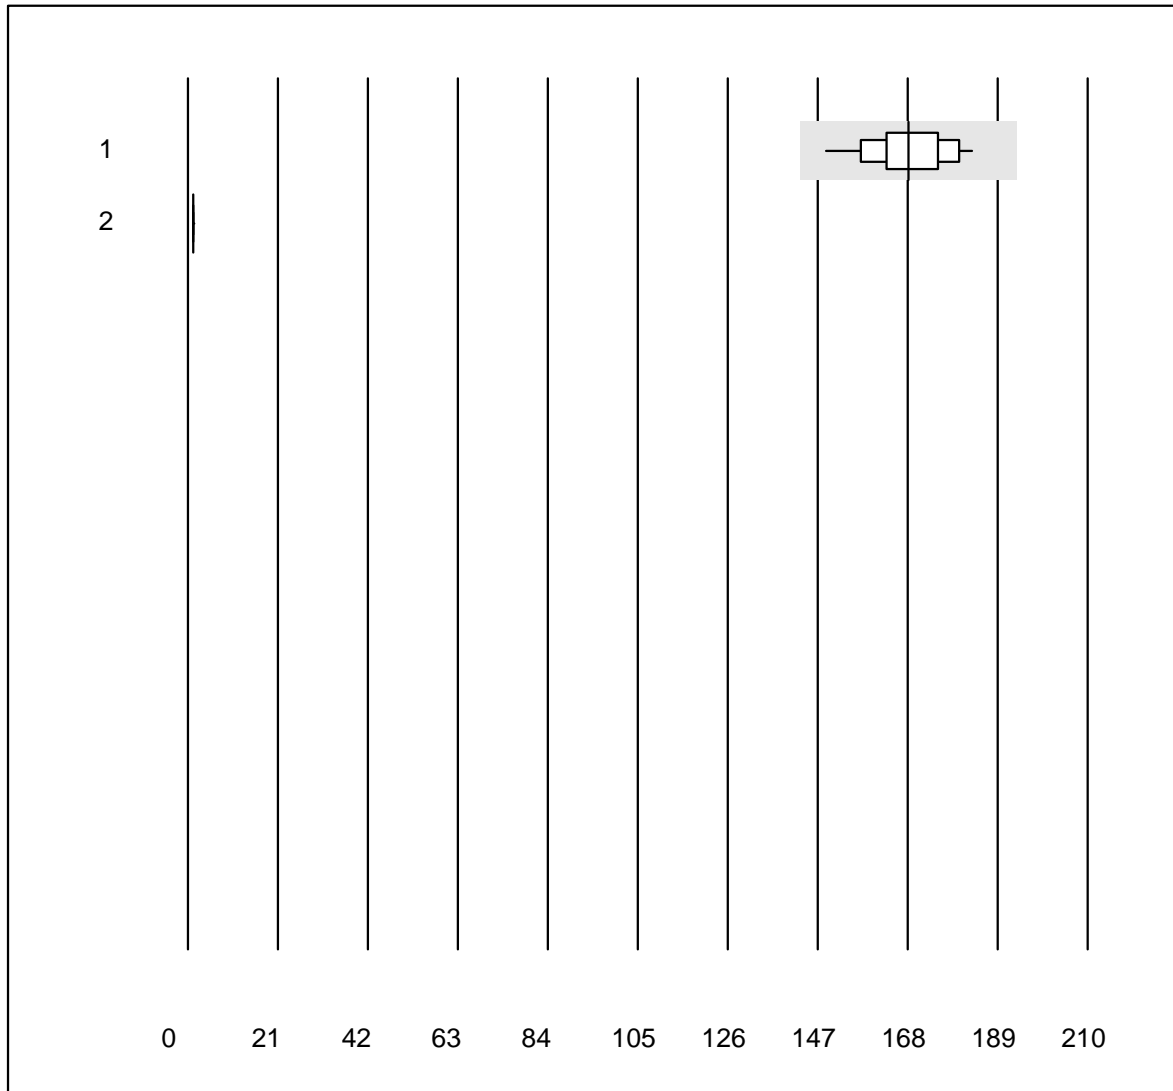


Tolérance MQ : 15 %

Index hémolytique échantillon A ()

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	15	100.0	0.0	0.0	168.13	5.5	e
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	1.27	2.6	e

## Index hémolytique échantillon B

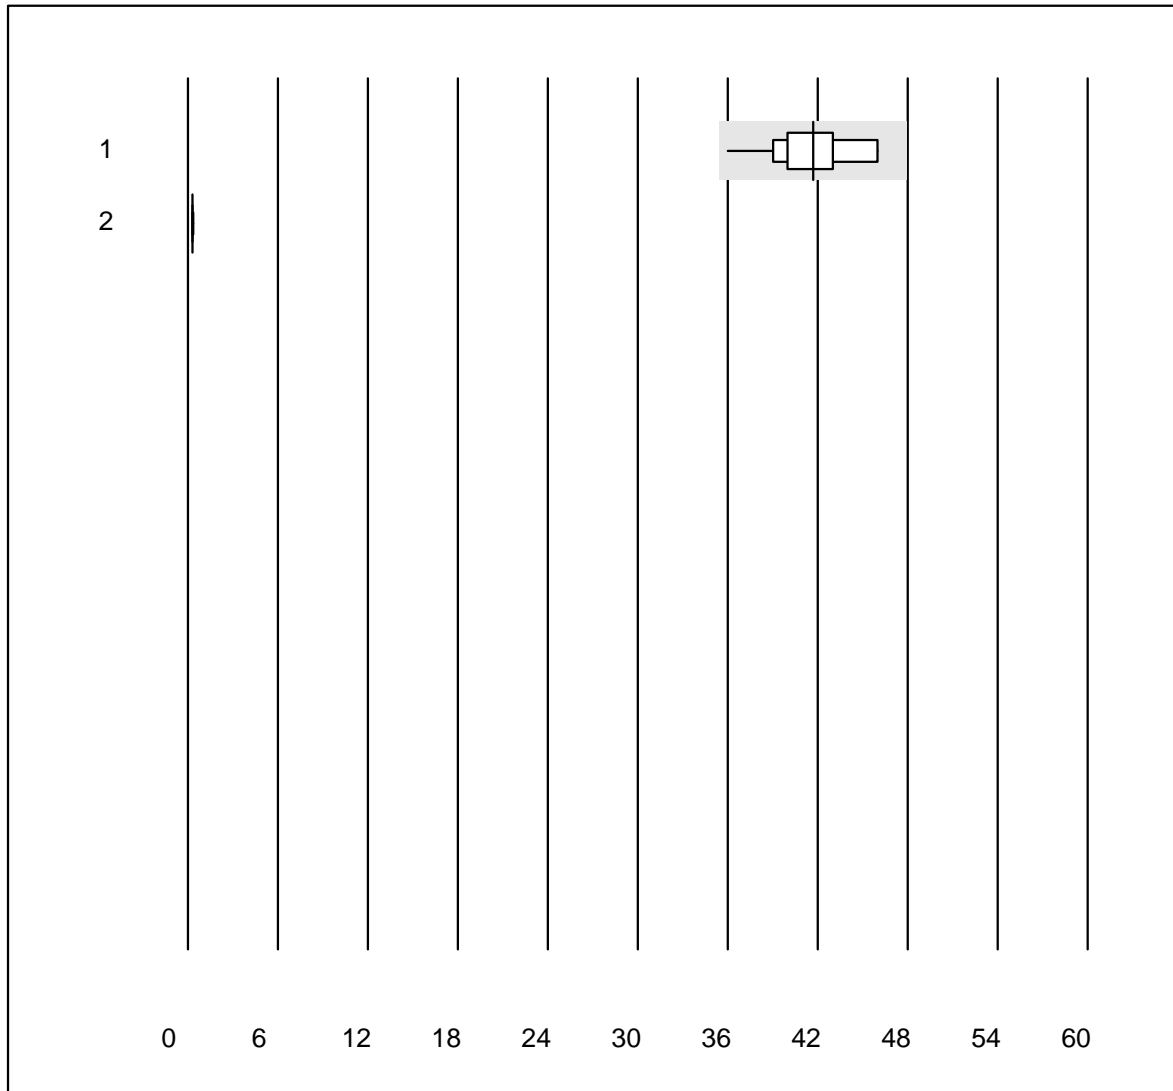


Tolérance MQ : 15 %

Index hémolytique échantillon B ( )

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	16	100.0	0.0	0.0	41.69	6.4	e
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	0.31	5.5	e*

## Vitesse de sédimentation 1h

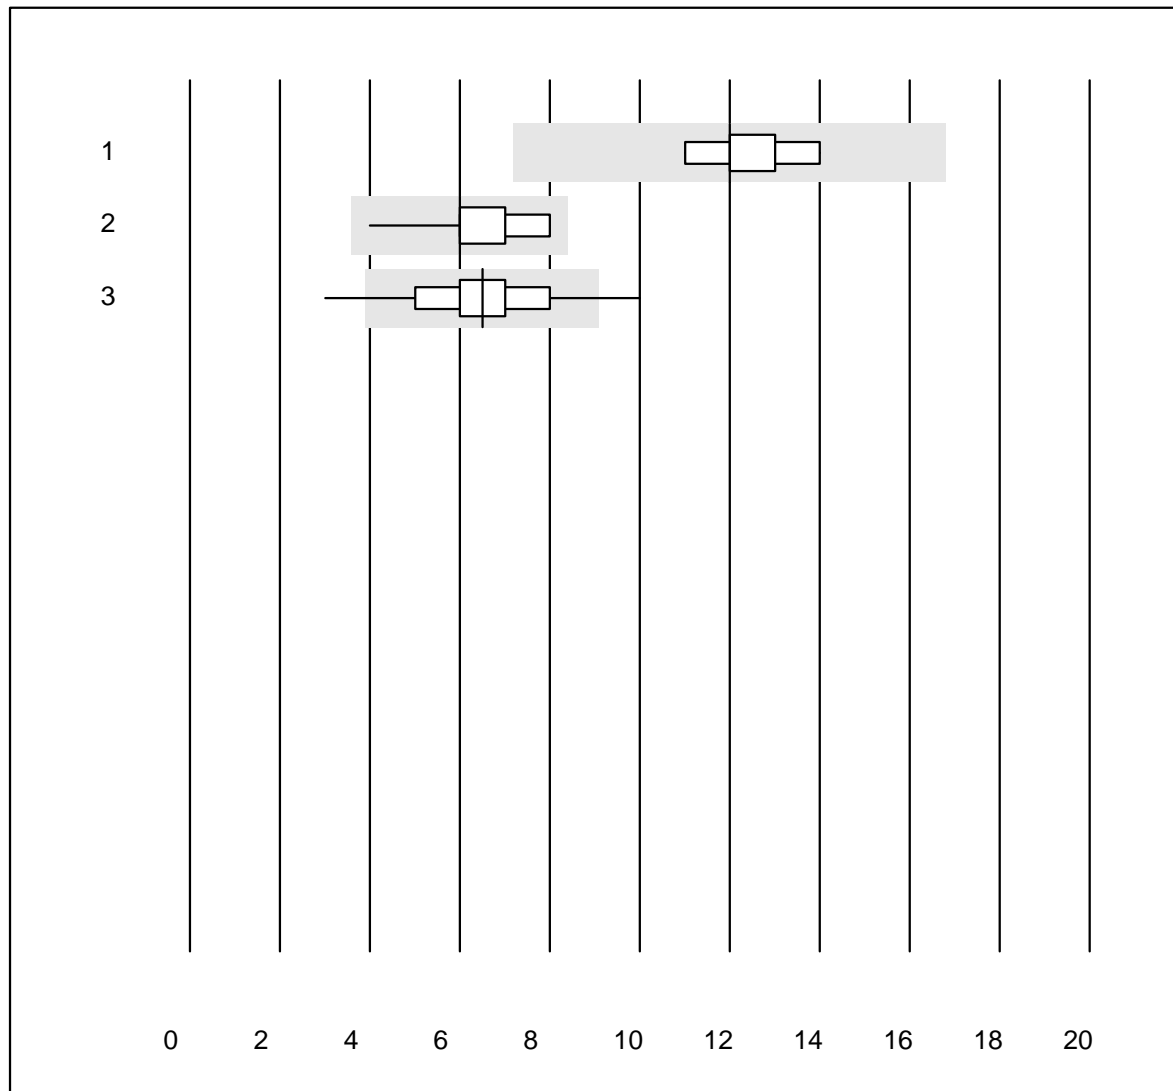


Tolérance MQ : 30 %

Vitesse de sédimentation 1h (mm/h)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	MINI-CUBE	6	100.0	0.0	0.0	12	8.4	a
2	Sarstedt Sedivette	12	91.7	0.0	8.3	6	17.5	a
3	BD Seditainer	33	87.9	9.1	3.0	7	21.9	a



## Vitesse de sédimentation 2h

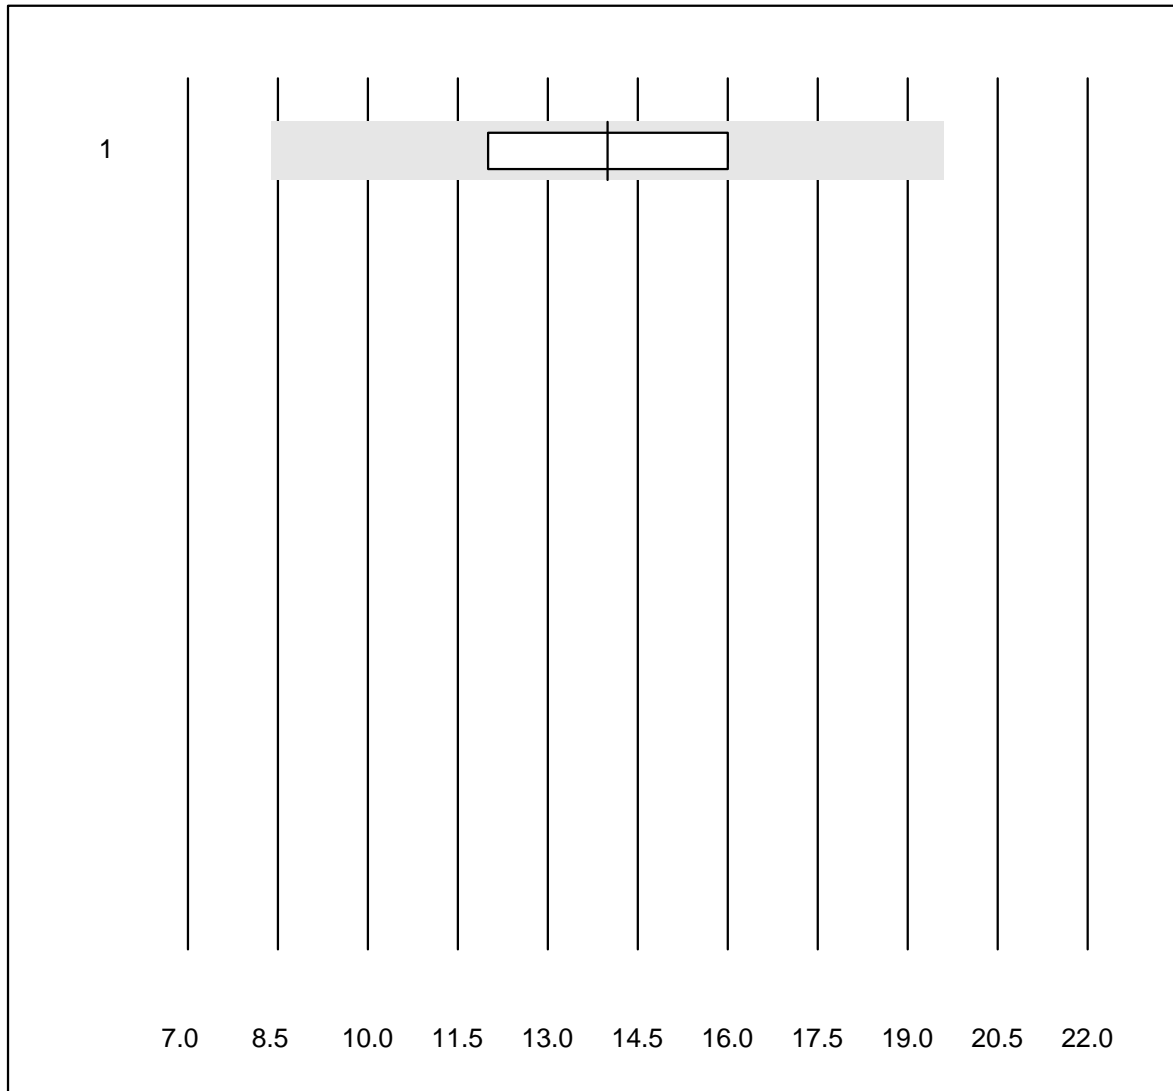


Tolérance MQ : 30 %

Vitesse de sédimentation 2h (mm/2h)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 BD Seditainer	6	100.0	0.0	0.0	14	12.8	a

## CRP

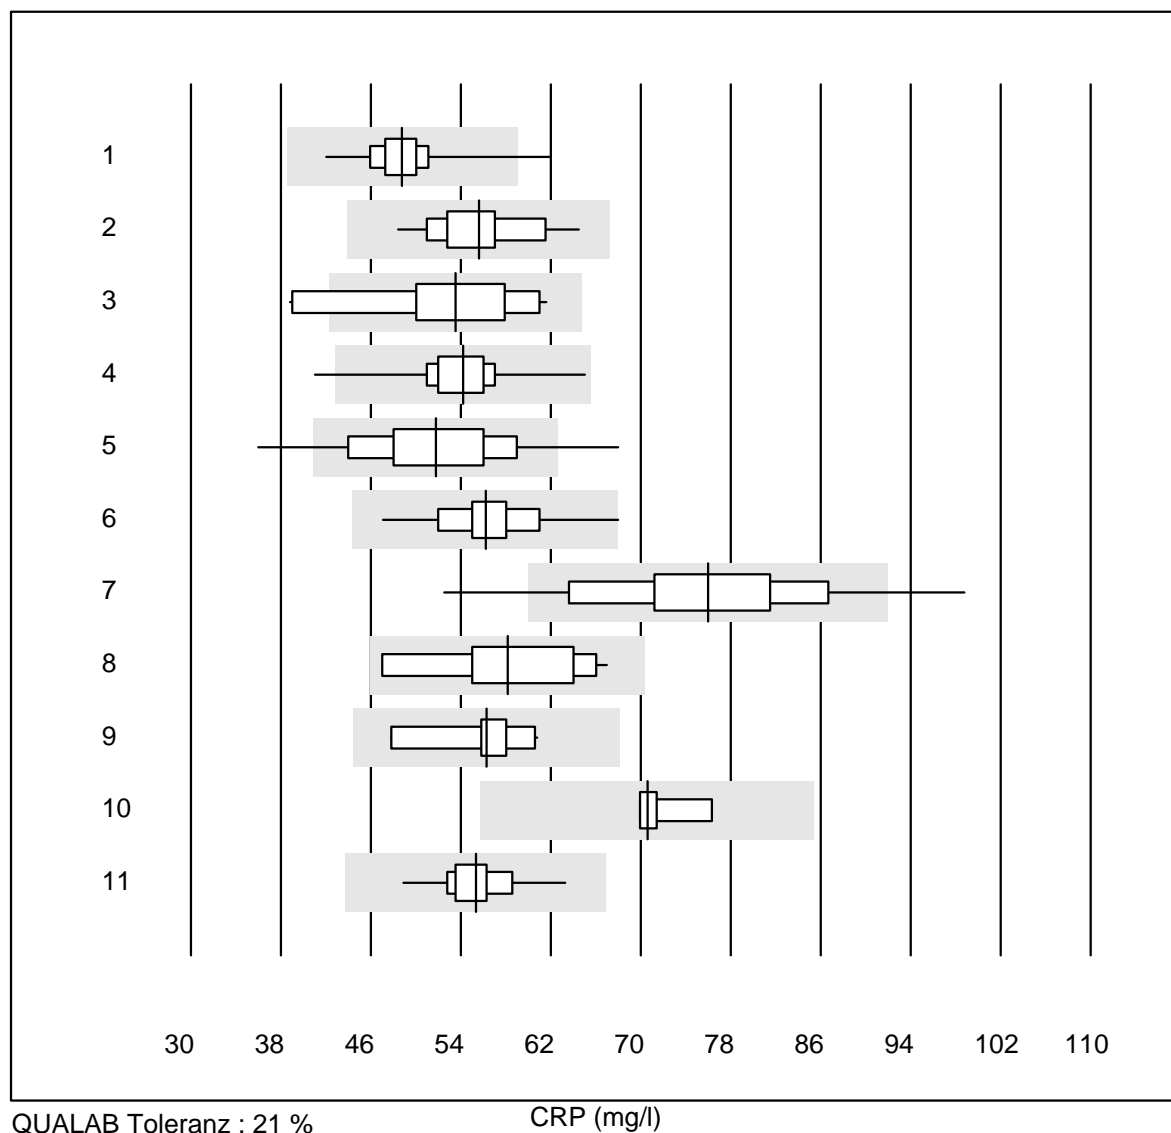


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas b101	251	98.8	0.8	0.4	48.8	4.9	e
2	Cobas	23	100.0	0.0	0.0	55.6	7.6	e
3	Turbidimetrie	14	85.7	14.3	0.0	53.5	13.3	e*
4	Afinion	1289	99.4	0.2	0.4	54.2	5.2	e
5	NycoCard SingleTest-	131	80.2	9.9	9.9	51.8	12.5	e
6	Quick Read go	104	97.1	1.0	1.9	56.2	6.3	e
7	Eurolyser	91	75.8	8.8	15.4	76.0	11.9	e
8	Fuji Dri-Chem	15	93.3	0.0	6.7	58.1	11.8	e*
9	Autolyser/DiaSys	11	90.9	0.0	9.1	56.3	7.2	e
10	Piccolo	5	80.0	0.0	20.0	70.6	4.0	e
11	Celltac chemi	45	97.8	0.0	2.2	55.3	4.7	e

## CRP

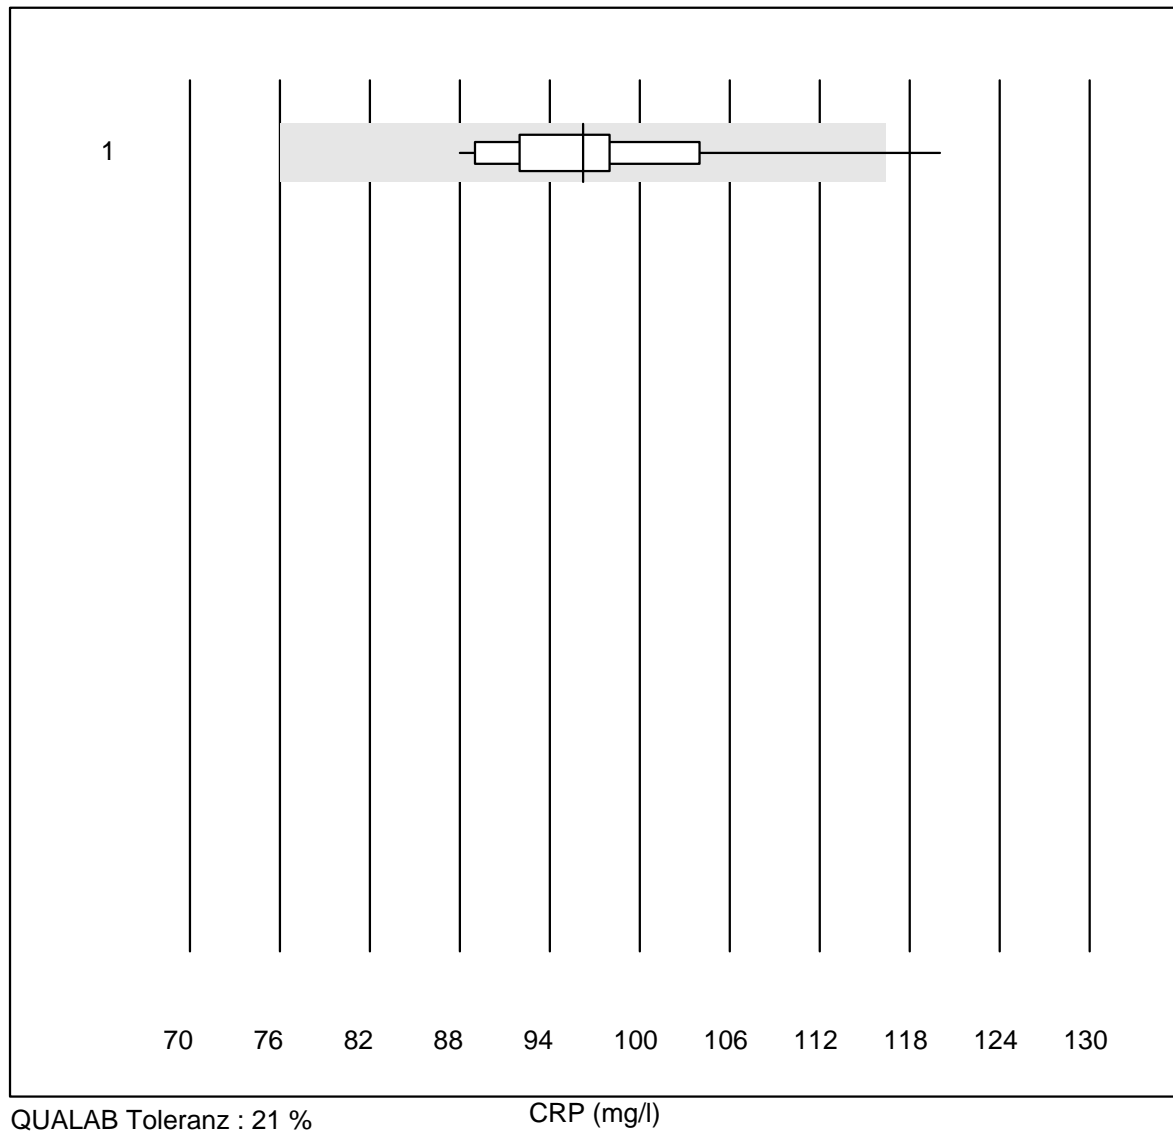


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	QuickRead (sang comp	41	90.2	4.9	4.9	96.2	7.2	e

## CRP

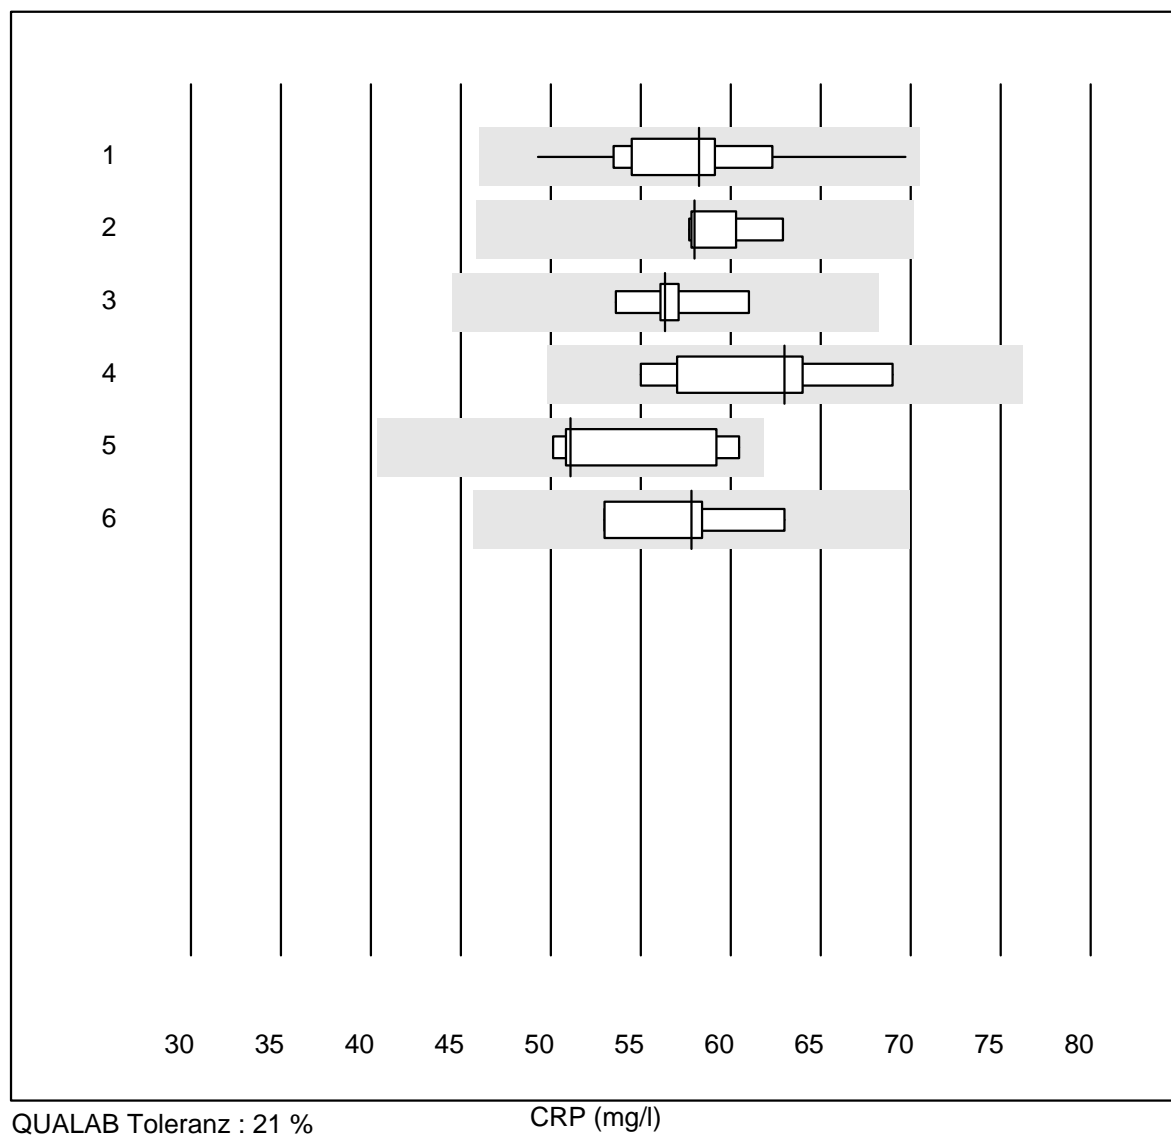

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Spinit	12	100.0	0.0	0.0	58.2	8.7	e
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	58.0	3.8	e
3 Beckman	6	100.0	0.0	0.0	56.4	4.2	e
4 AQT 90 FLEX	9	100.0	0.0	0.0	63.0	8.1	e*
5 Spotchem D-Concept	7	85.7	0.0	14.3	51.1	8.3	e*
6 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	57.8	7.1	e*

## IgG

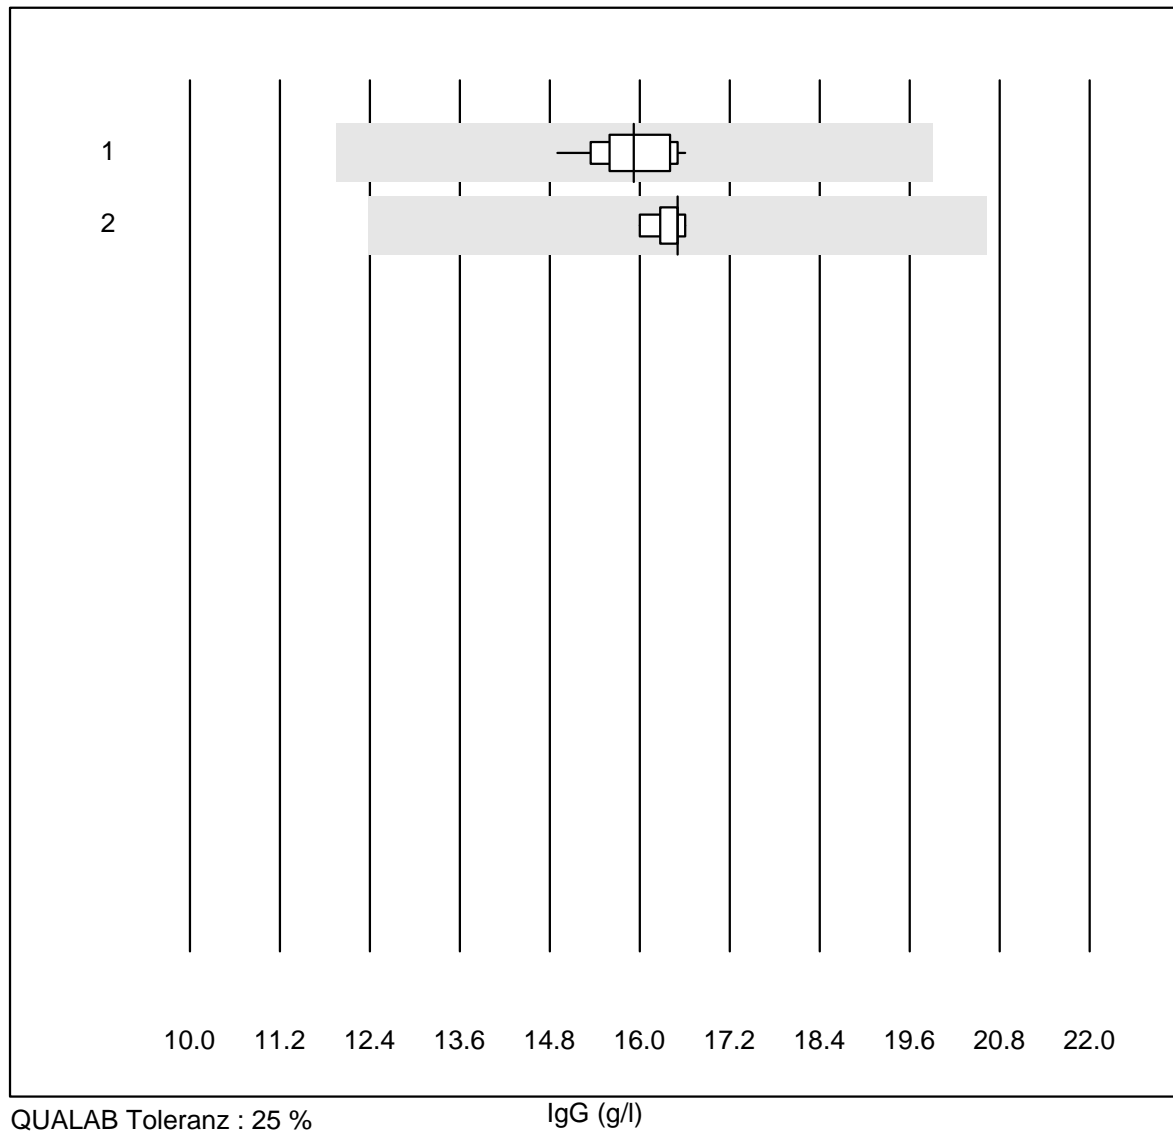


QUALAB Toleranz : 25 %

IgG (g/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Turbidimetrie	15	100.0	0.0	0.0	15.9	3.0	e
2	Nephelometrie	5	100.0	0.0	0.0	16.5	1.5	e


## IgA

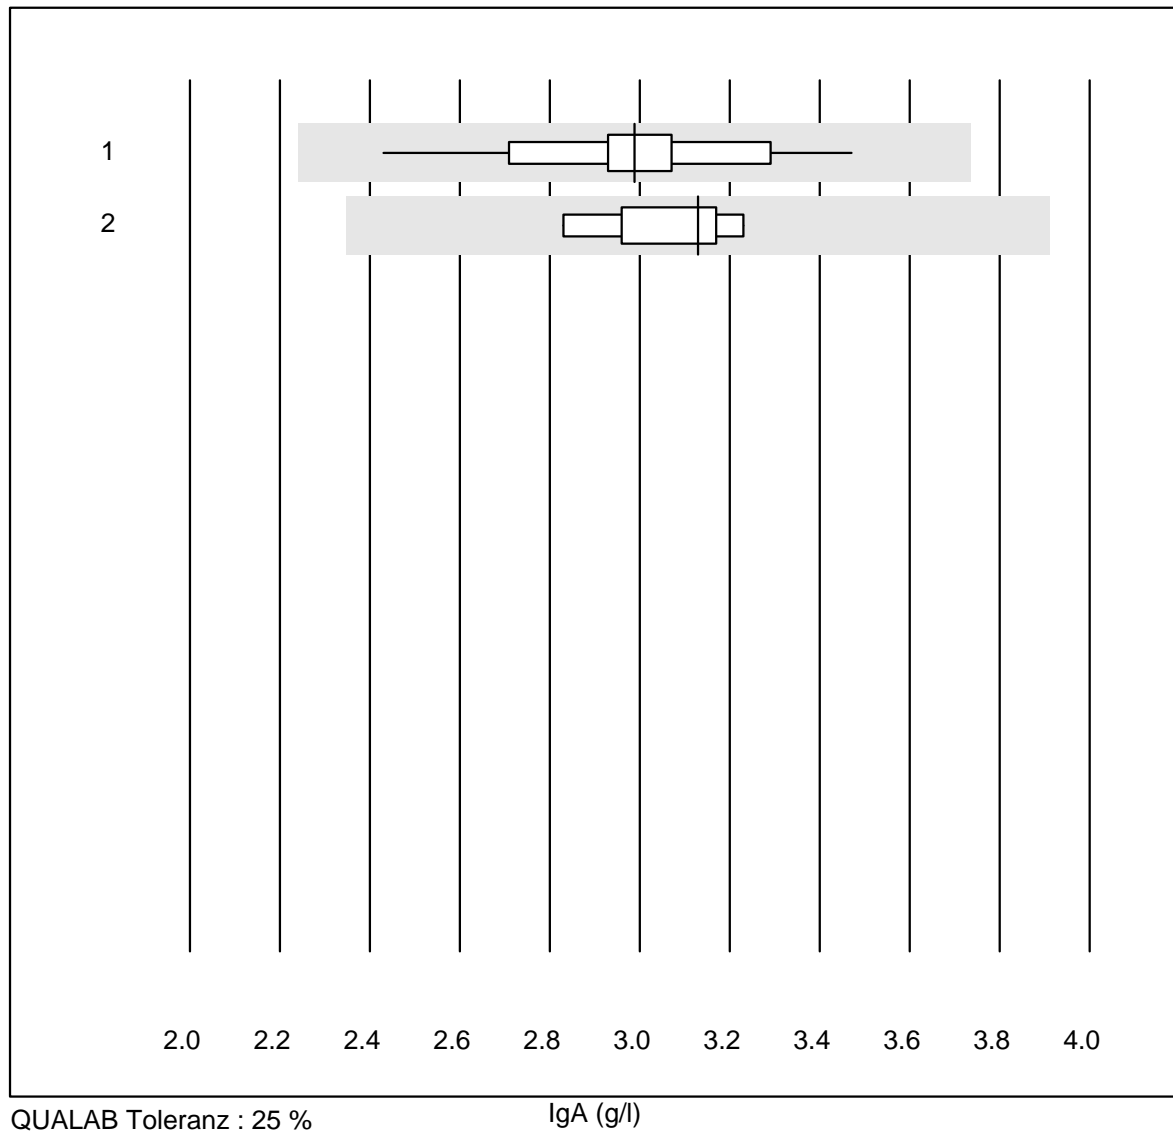

QUALAB Toleranz : 25 %

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Turbidimetrie	15	100.0	0.0	0.0	3.0	7.8	e
2	Nephelometrie	5	100.0	0.0	0.0	3.1	5.4	e

## IgM

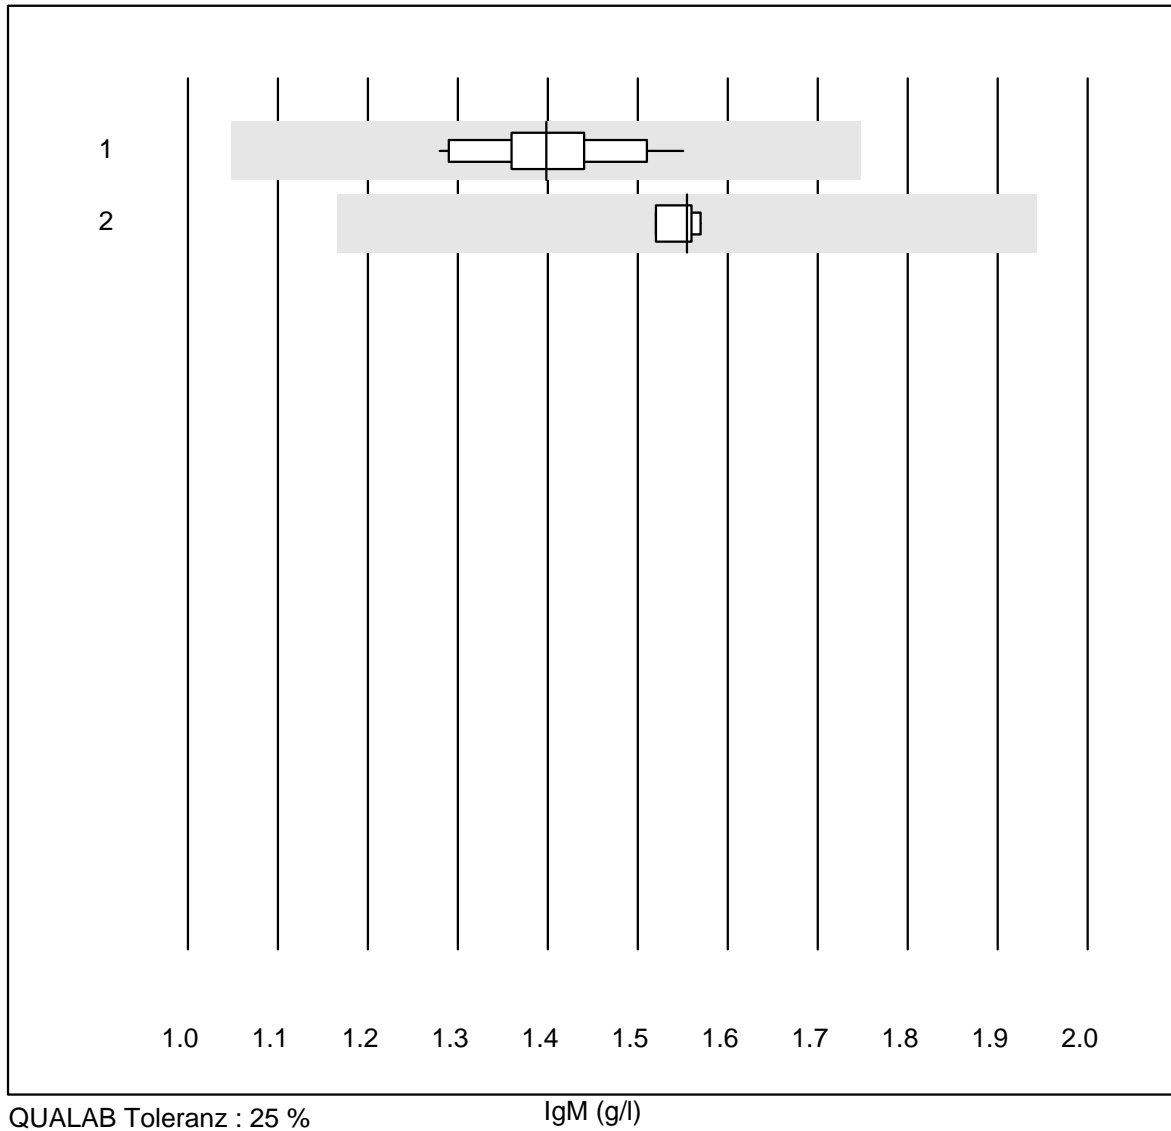


QUALAB Toleranz : 25 %

IgM (g/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Turbidimetrie	15	100.0	0.0	0.0	1.4	5.4	e
2	Nephelometrie	4	100.0	0.0	0.0	1.6	1.4	e

## IgE

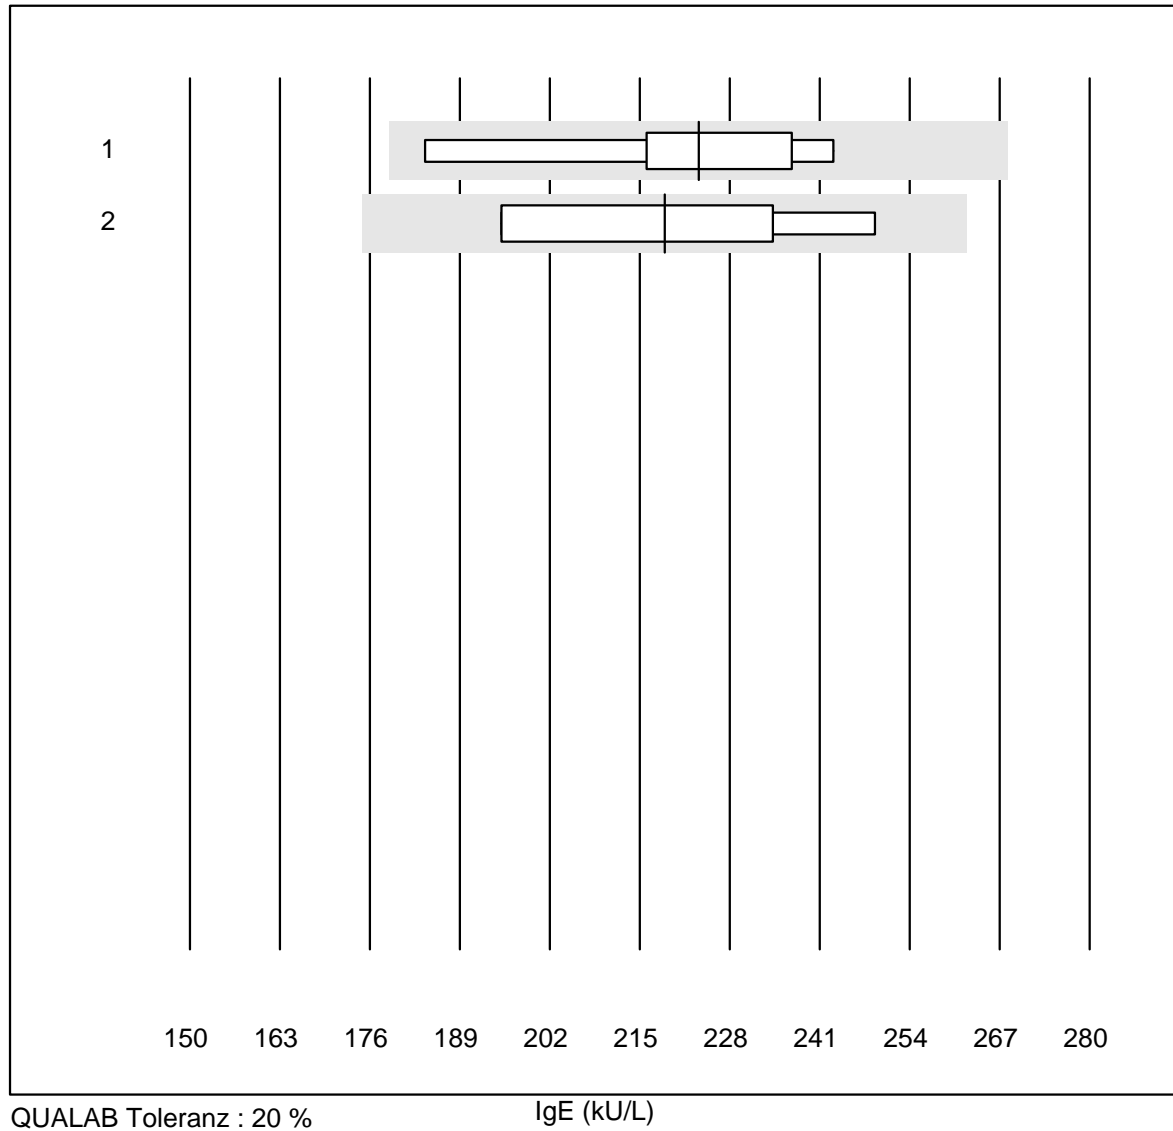


QUALAB Toleranz : 20 %

IgE (kU/L)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	224	9.5	e*
2	Cobas	4	100.0	0.0	0.0	219	11.6	e*



## Alpha-1-Antitrypsine

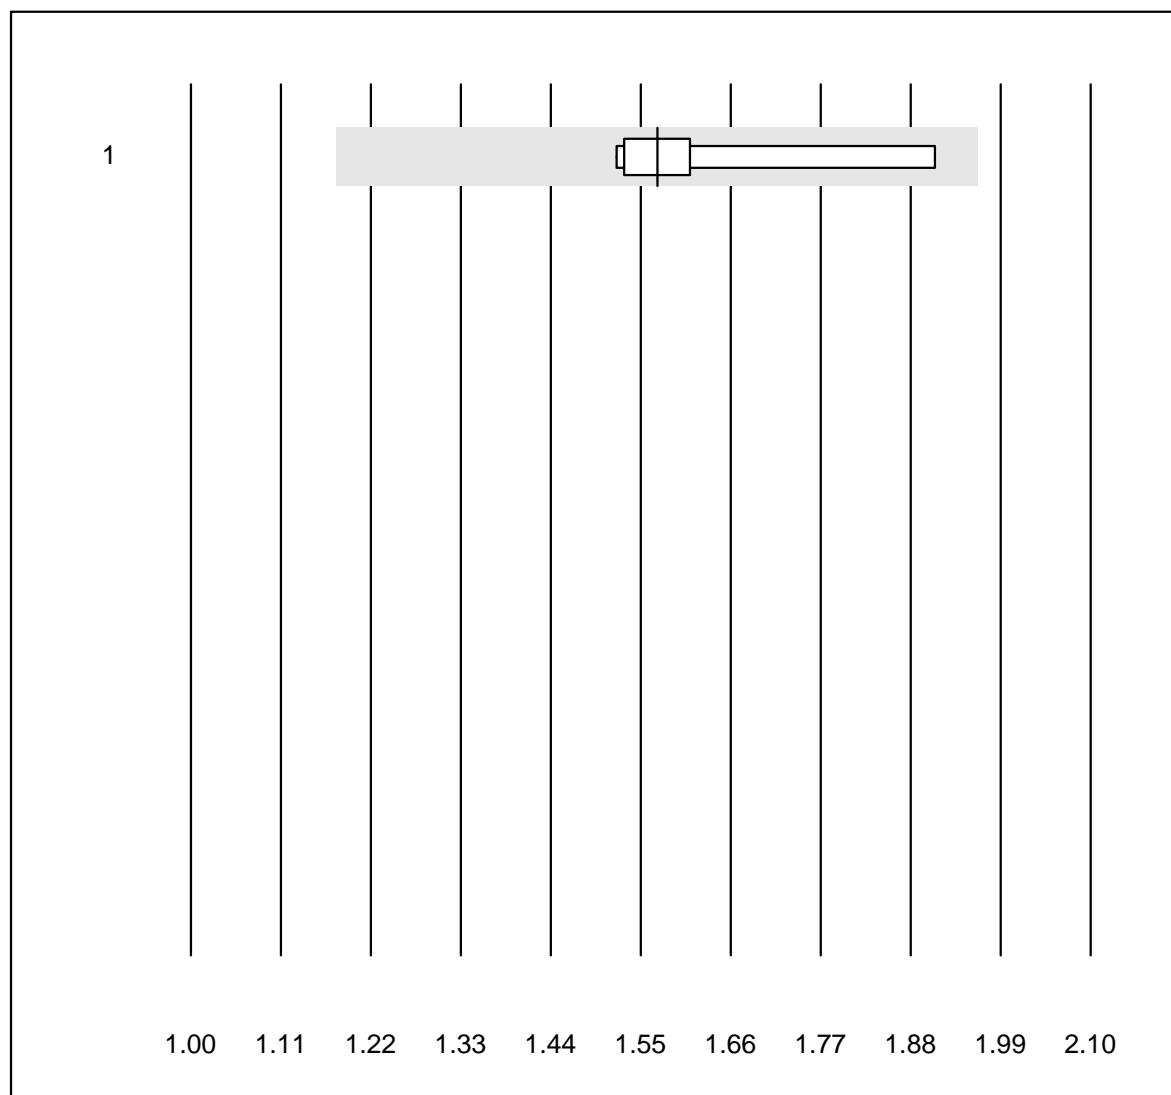


Tolérance MQ : 25 %

Alpha-1-Antitrypsine (g/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	8	100.0	0.0	0.0	1.57	8.1	e

## Anti-Streptolysine-Anticorps

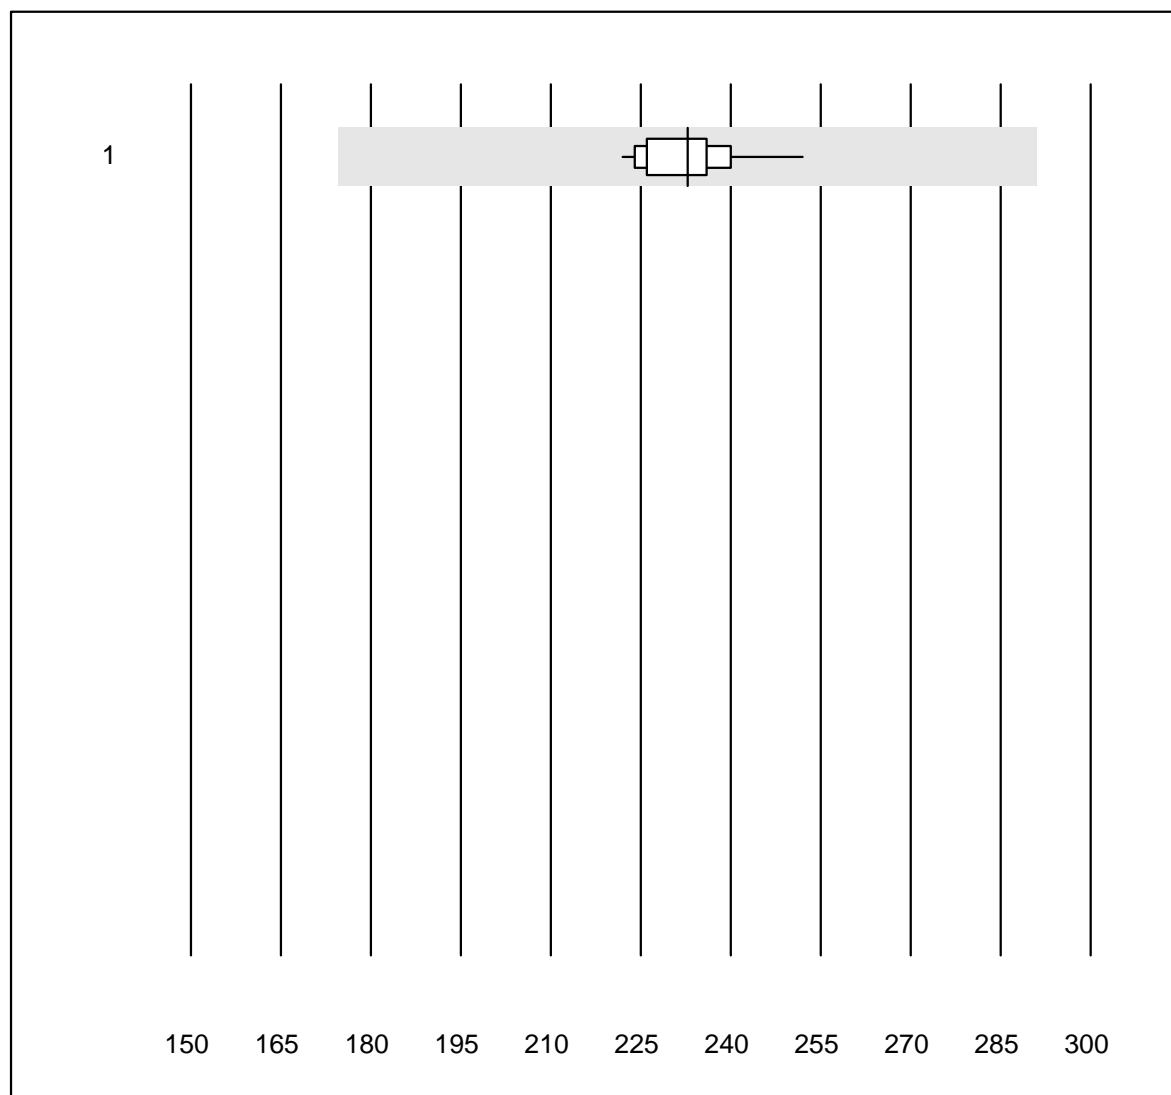


Tolérance MQ : 25 %

Anti-Streptolysine-Anticorps (kIU/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	11	100.0	0.0	0.0	233	3.6	e

## Complément C3

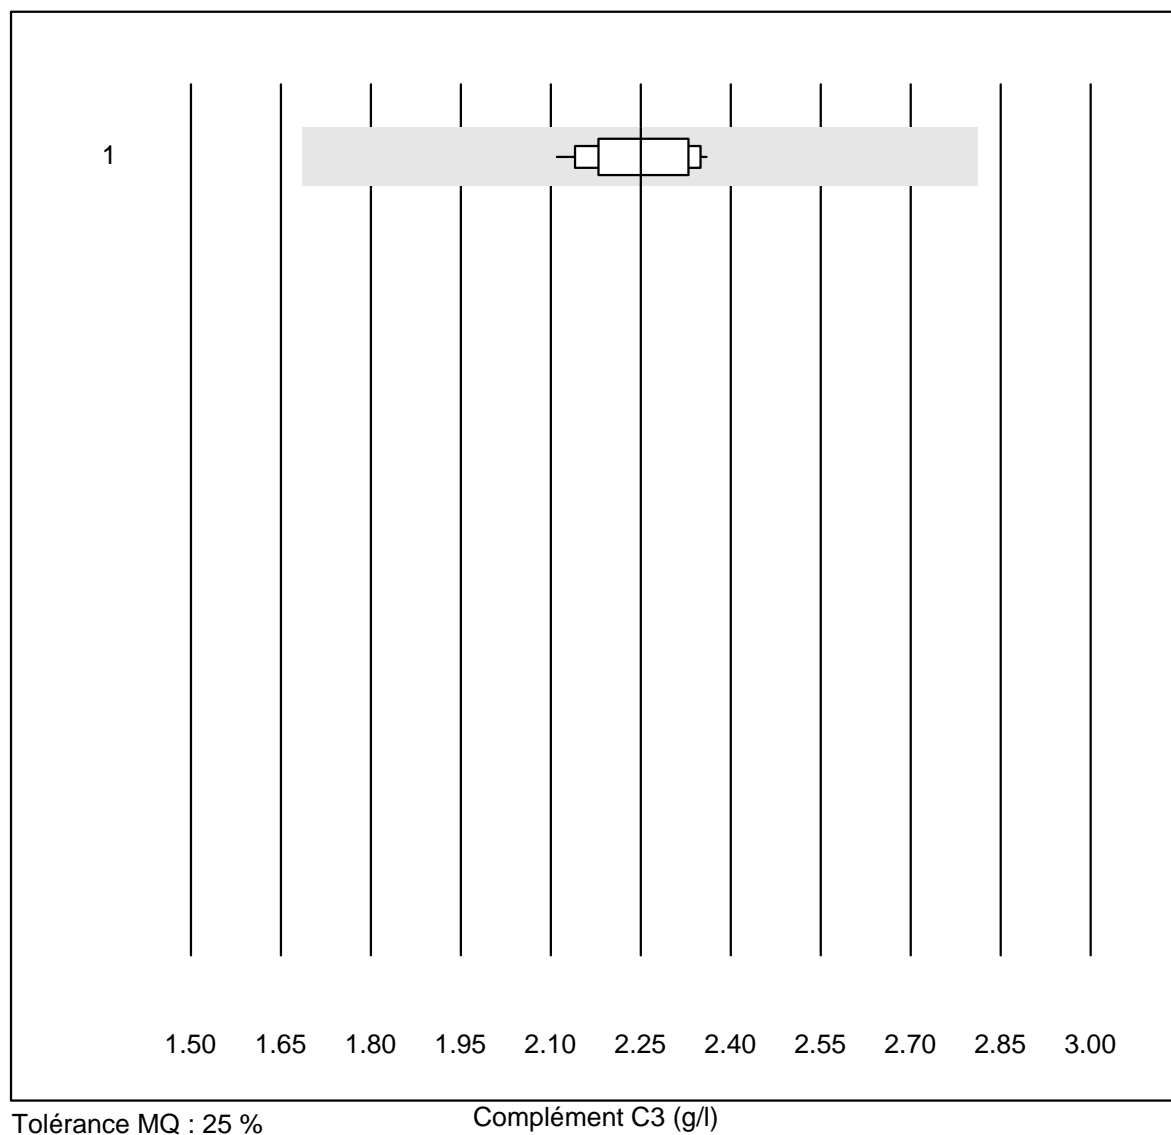


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	14	100.0	0.0	0.0	2.25	3.6	e

## Complément C4

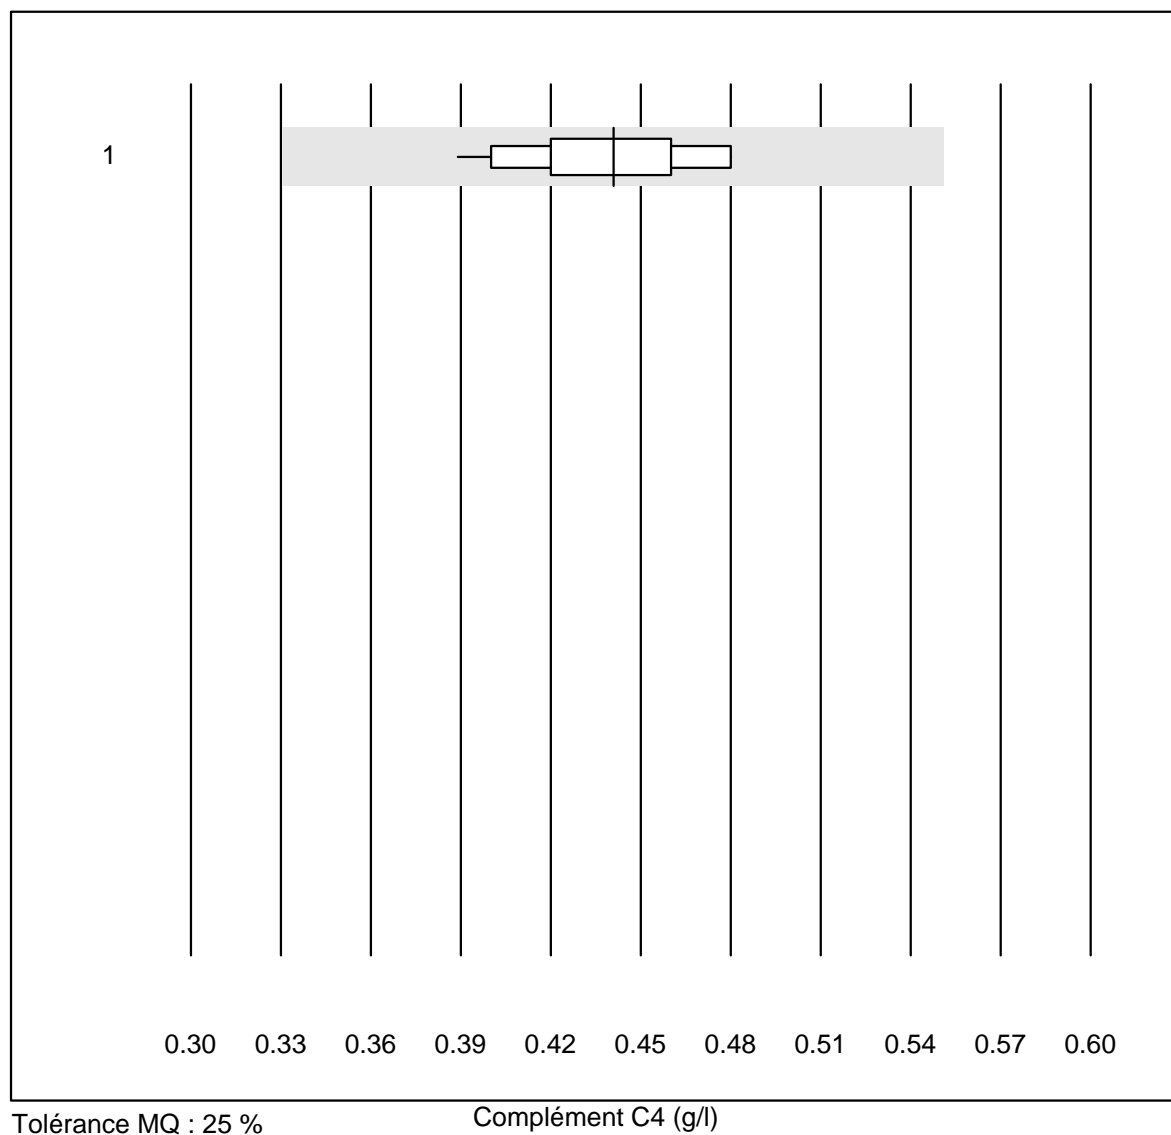


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	13	100.0	0.0	0.0	0.44	6.9	e

## Haptoglobine

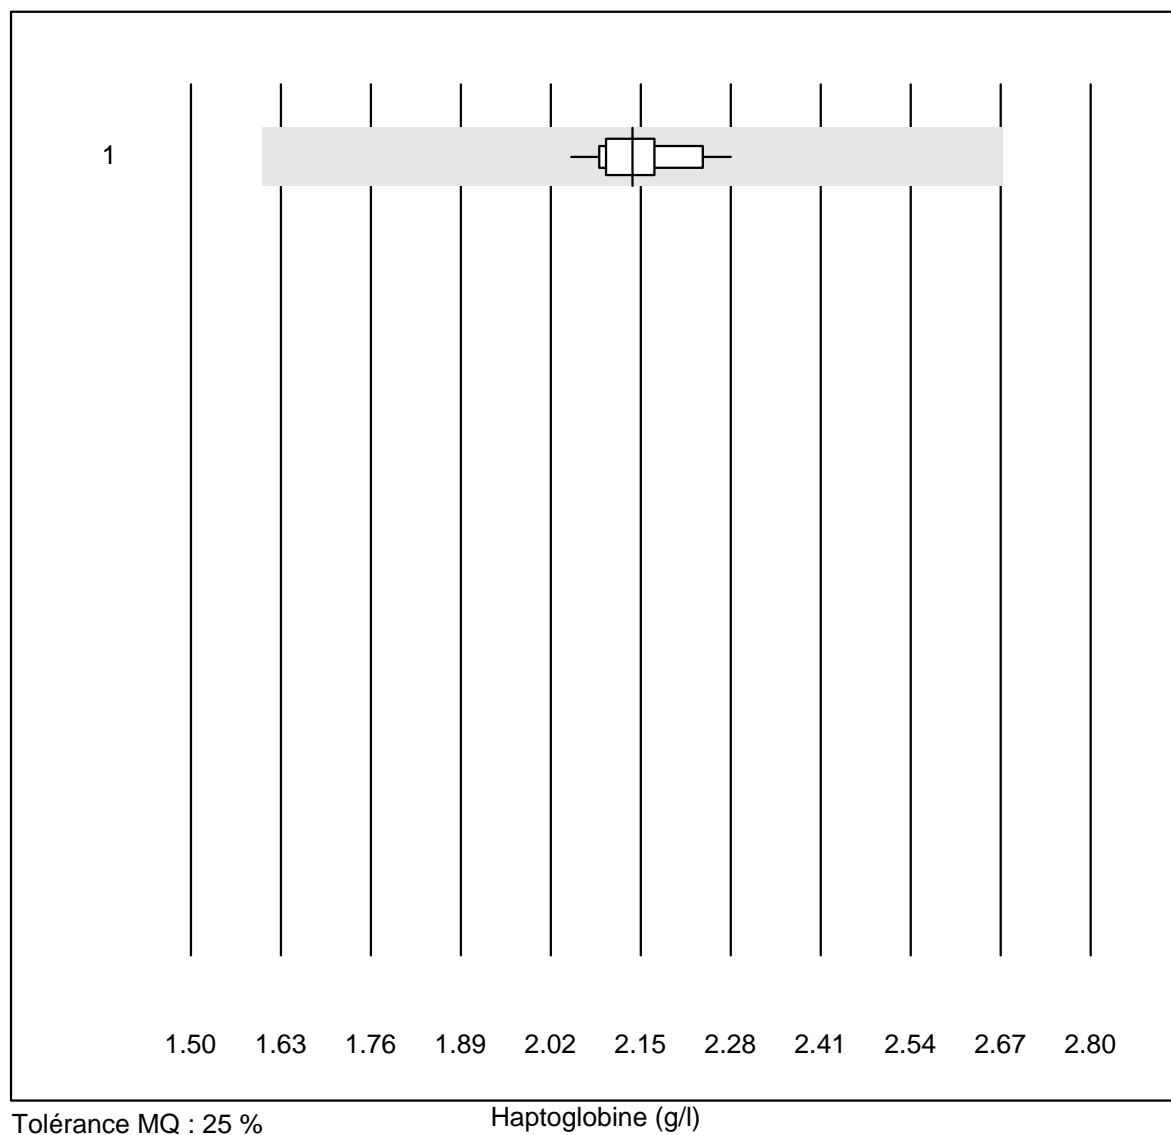


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	17	100.0	0.0	0.0	2.14	3.0	e

## Transferrine

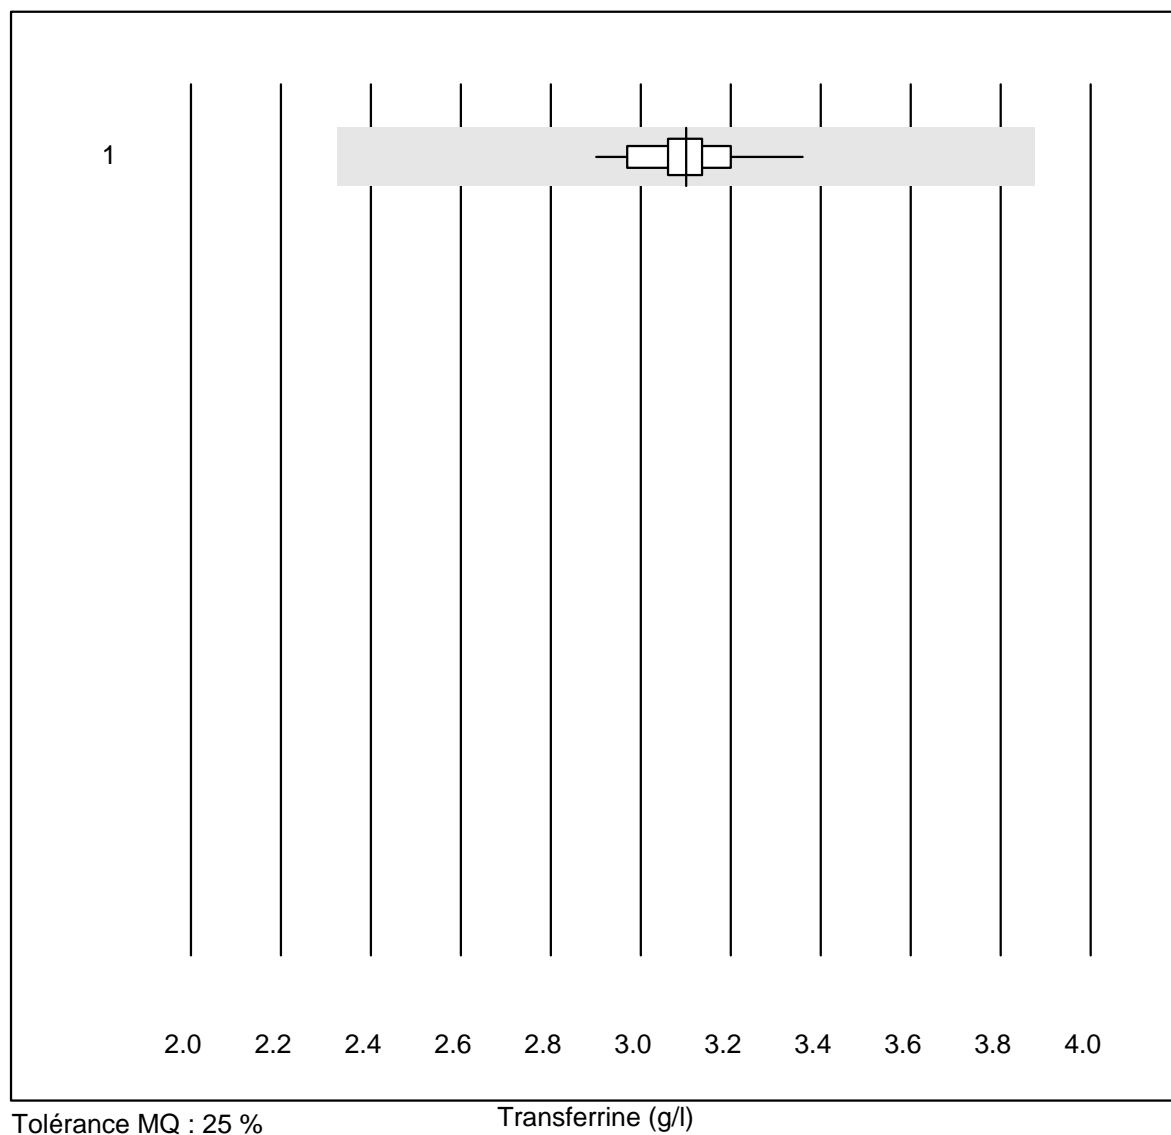


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	25	100.0	0.0	0.0	3.10	3.1	e

## Bêta-2 microglobuline

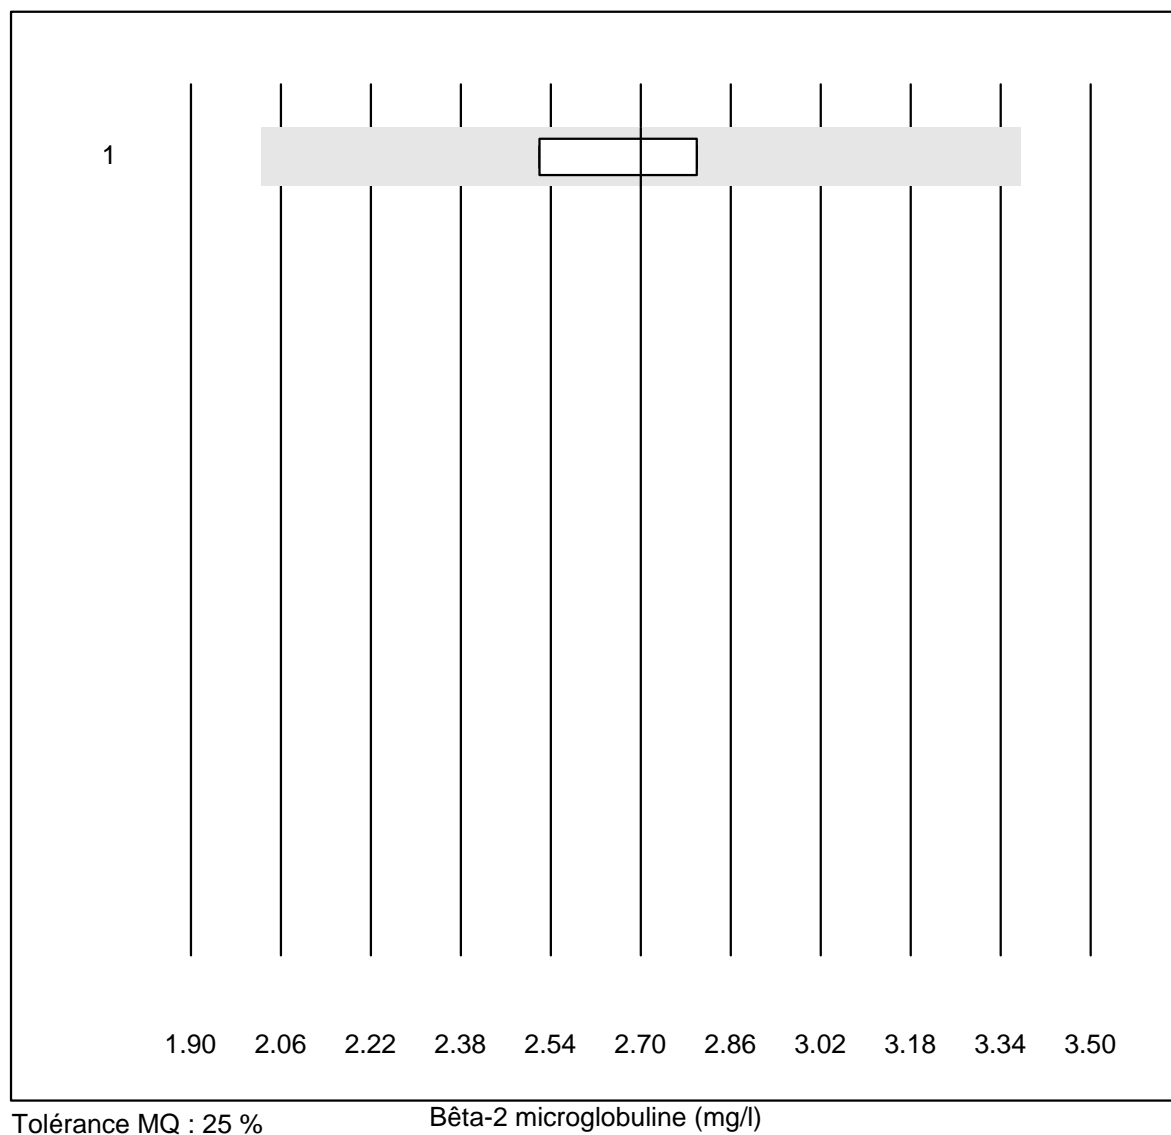

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	2.70	5.3	e

## Facteur rhumatoïde

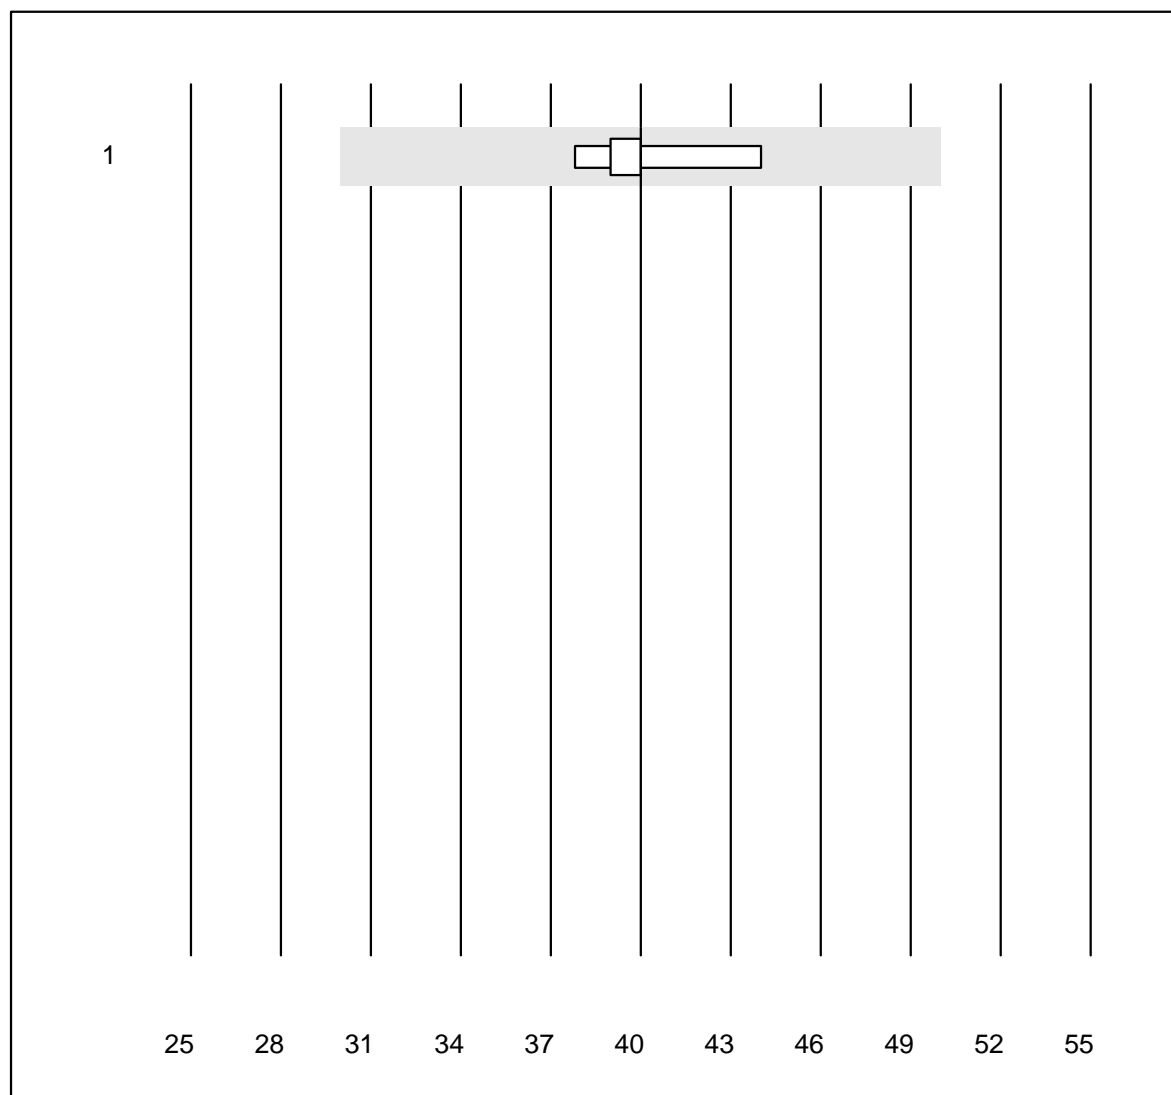


Tolérance MQ : 25 %

Facteur rhumatoïde (U/ml)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	40.0	5.8	e



## Céruleoplasmine

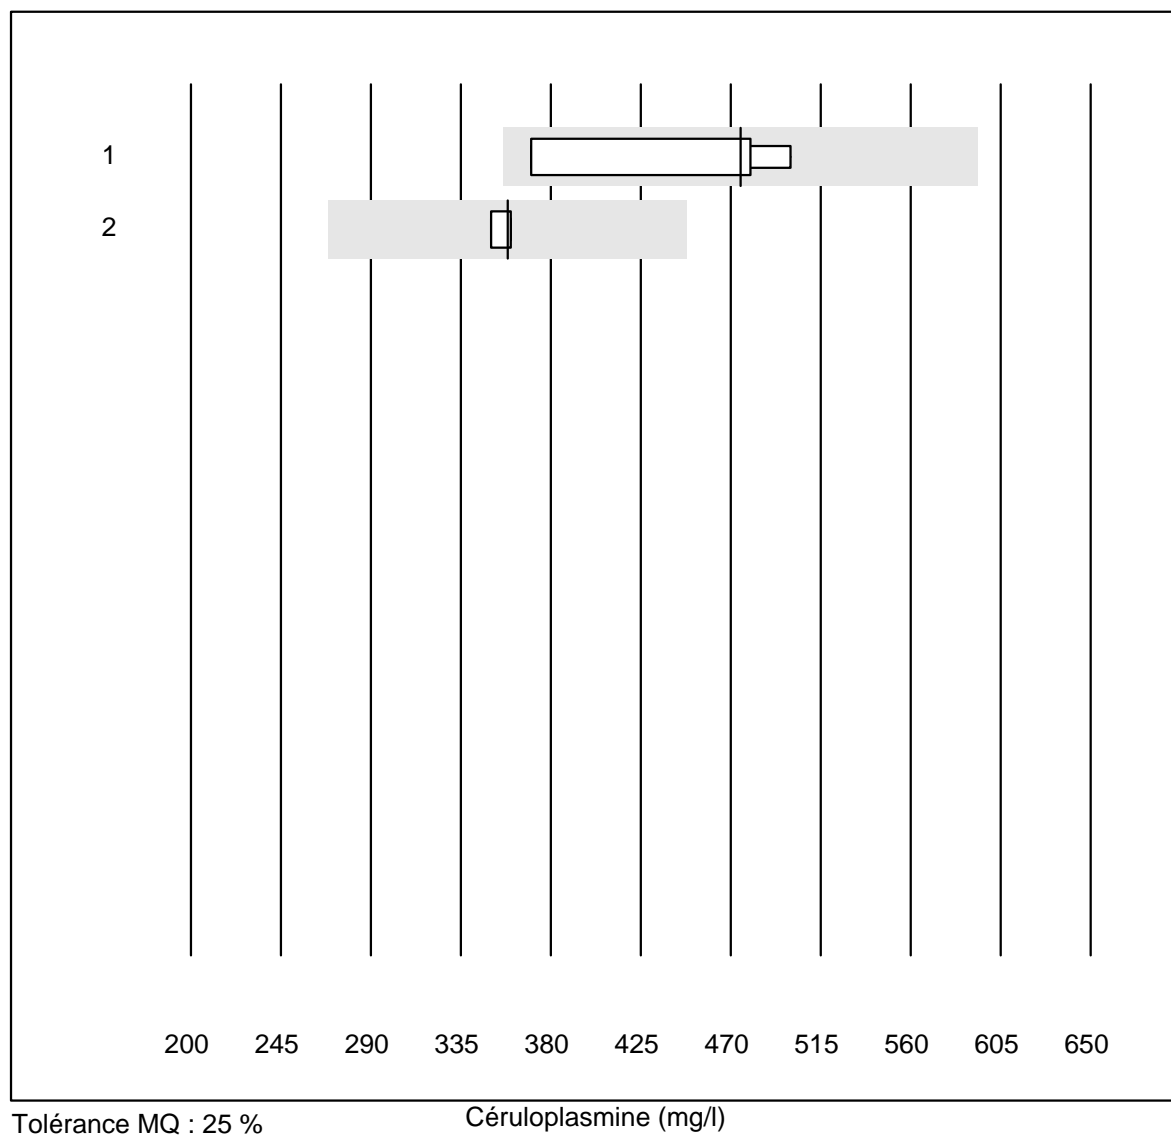


Tolérance MQ : 25 %

Céruleoplasmine (mg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Siemens	4	100.0	0.0	0.0	475.00	12.8	e*
2	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	358.50	1.3	e

## Pré-albumine

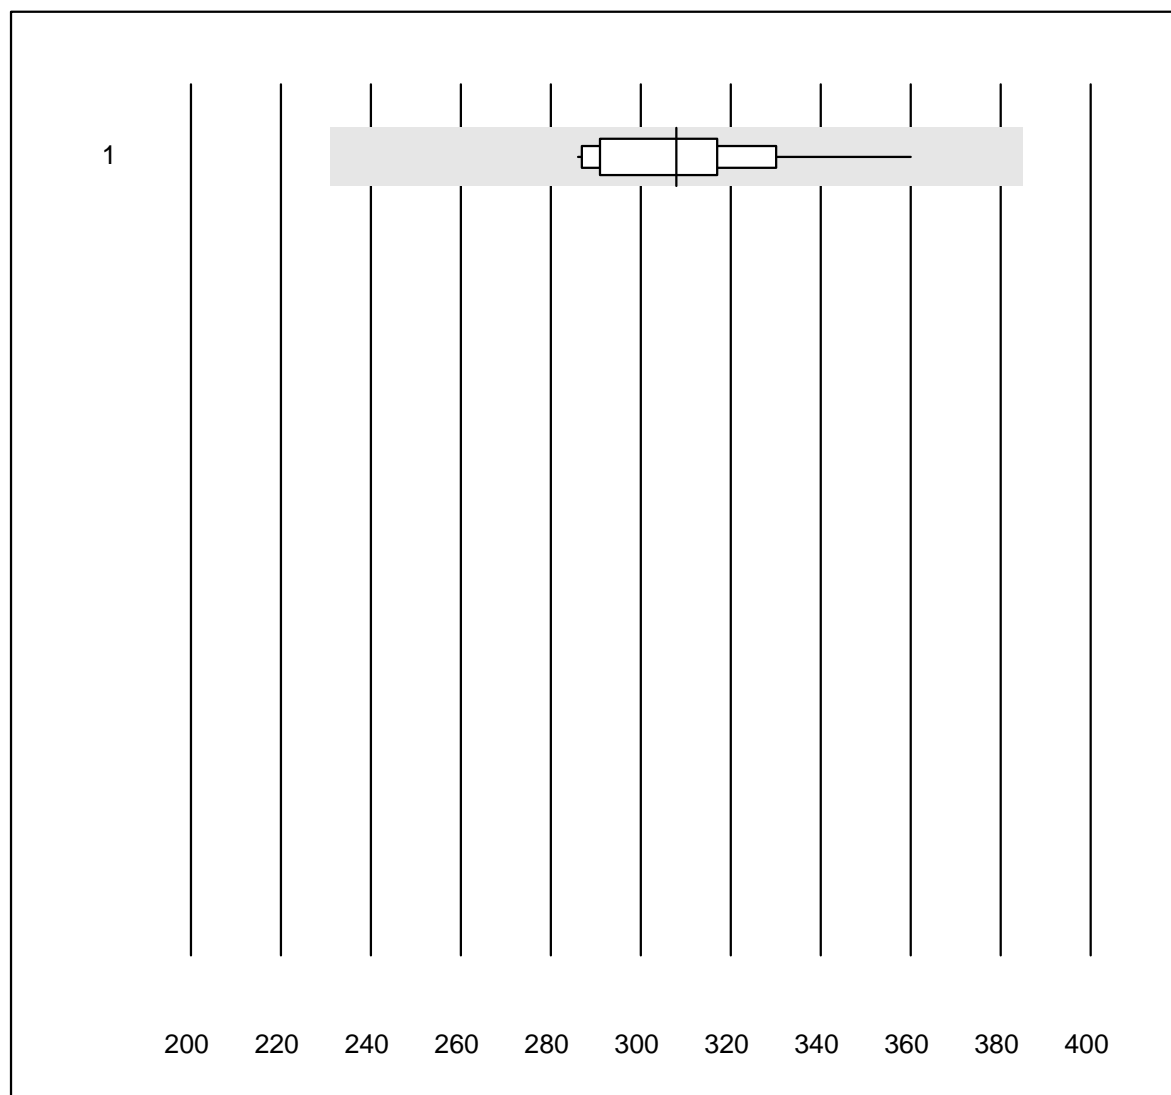


Tolérance MQ : 25 %

Pré-albumine (mg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	16	93.7	0.0	6.3	307.9	6.2	e

## Récepteur soluble de la transferrine

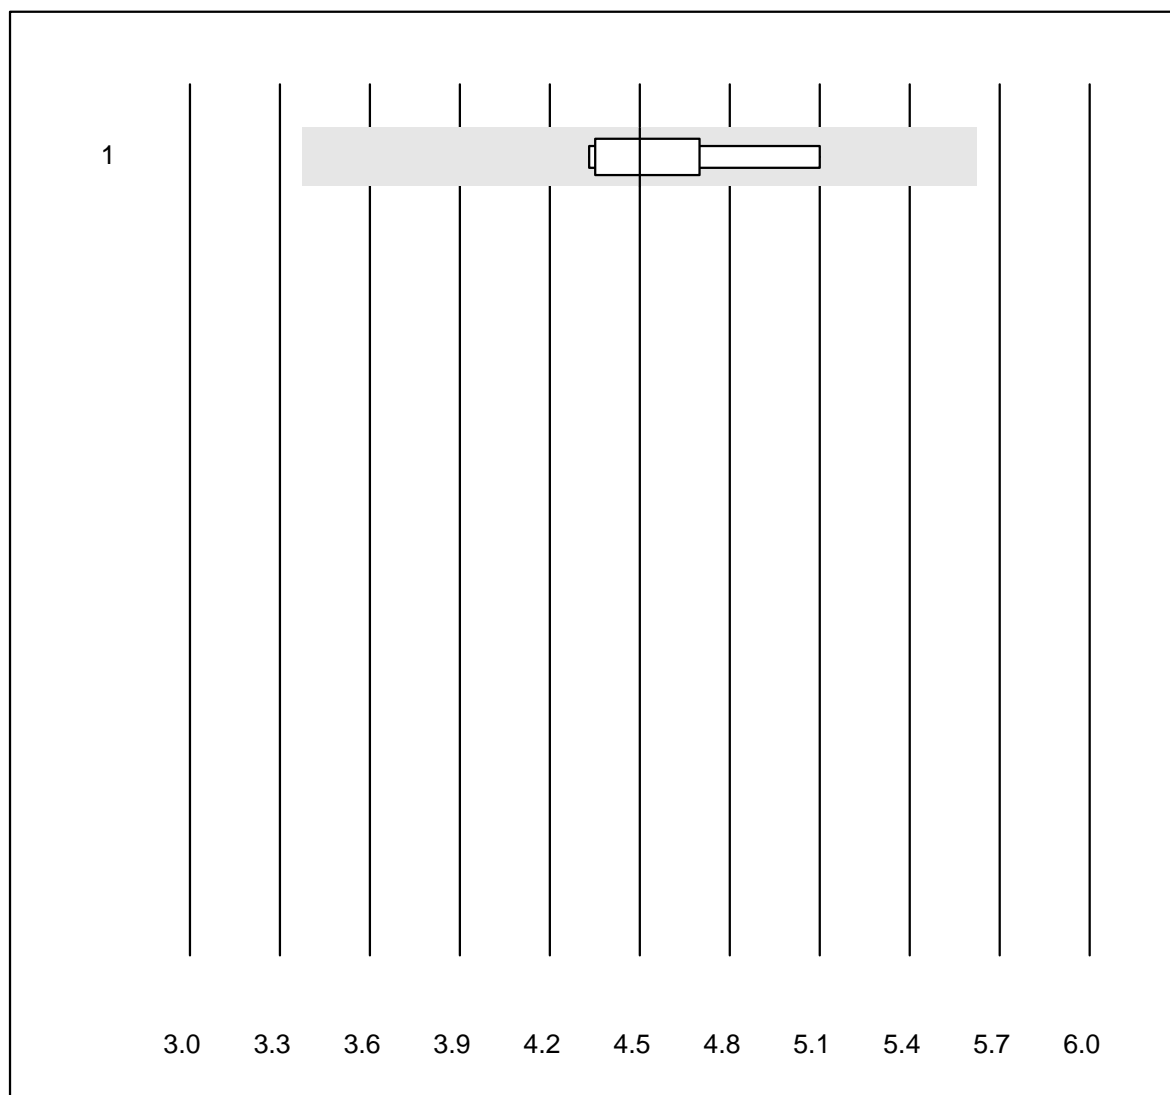


Tolérance MQ : 25 %

Récepteur soluble de la transferrine (mg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	4.5	5.9	e

# CRP HS

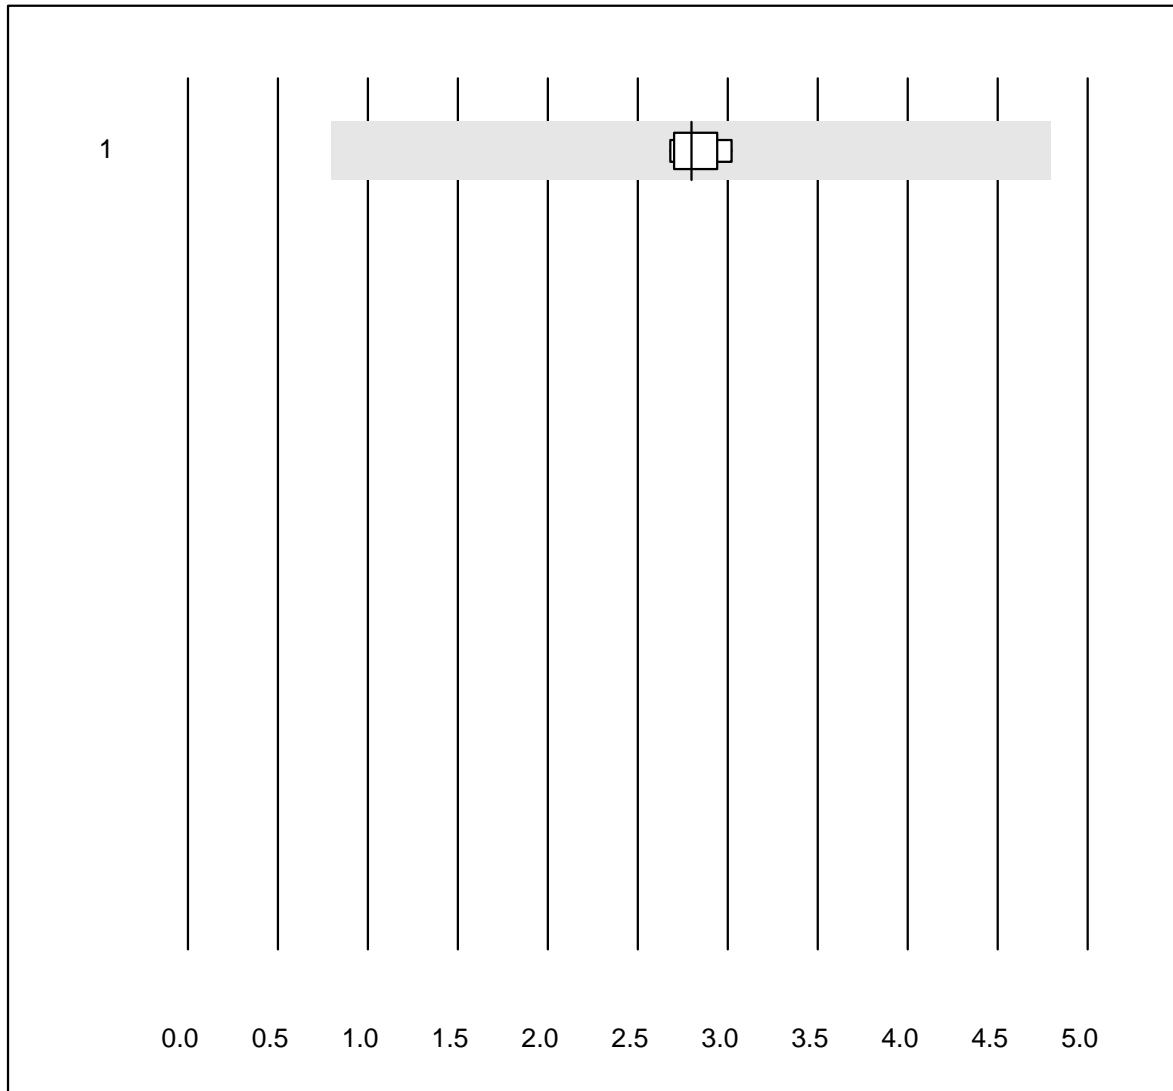


QUALAB Toleranz : 21 %  
 (< 10.00: +/- 2.00 mg/l)

CRP HS (mg/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Turbidimetrie	5	100.0	0.0	0.0	2.80	5.3	e

# CRP

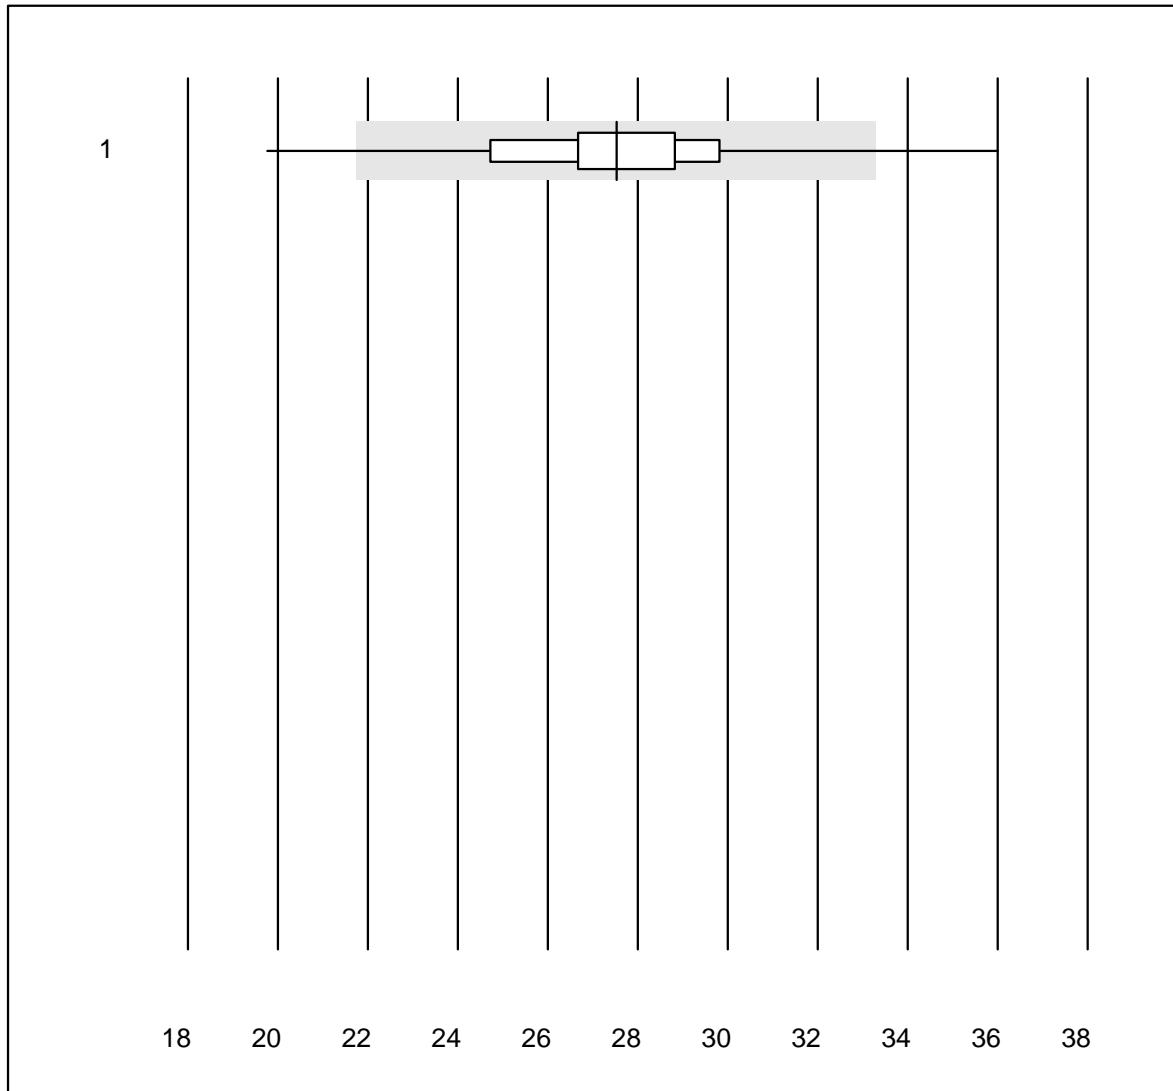


QUALAB Toleranz : 21 %

CRP (mg/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 AFIAS	121	91.7	3.3	5.0	27.5	8.8	e

# Albumine

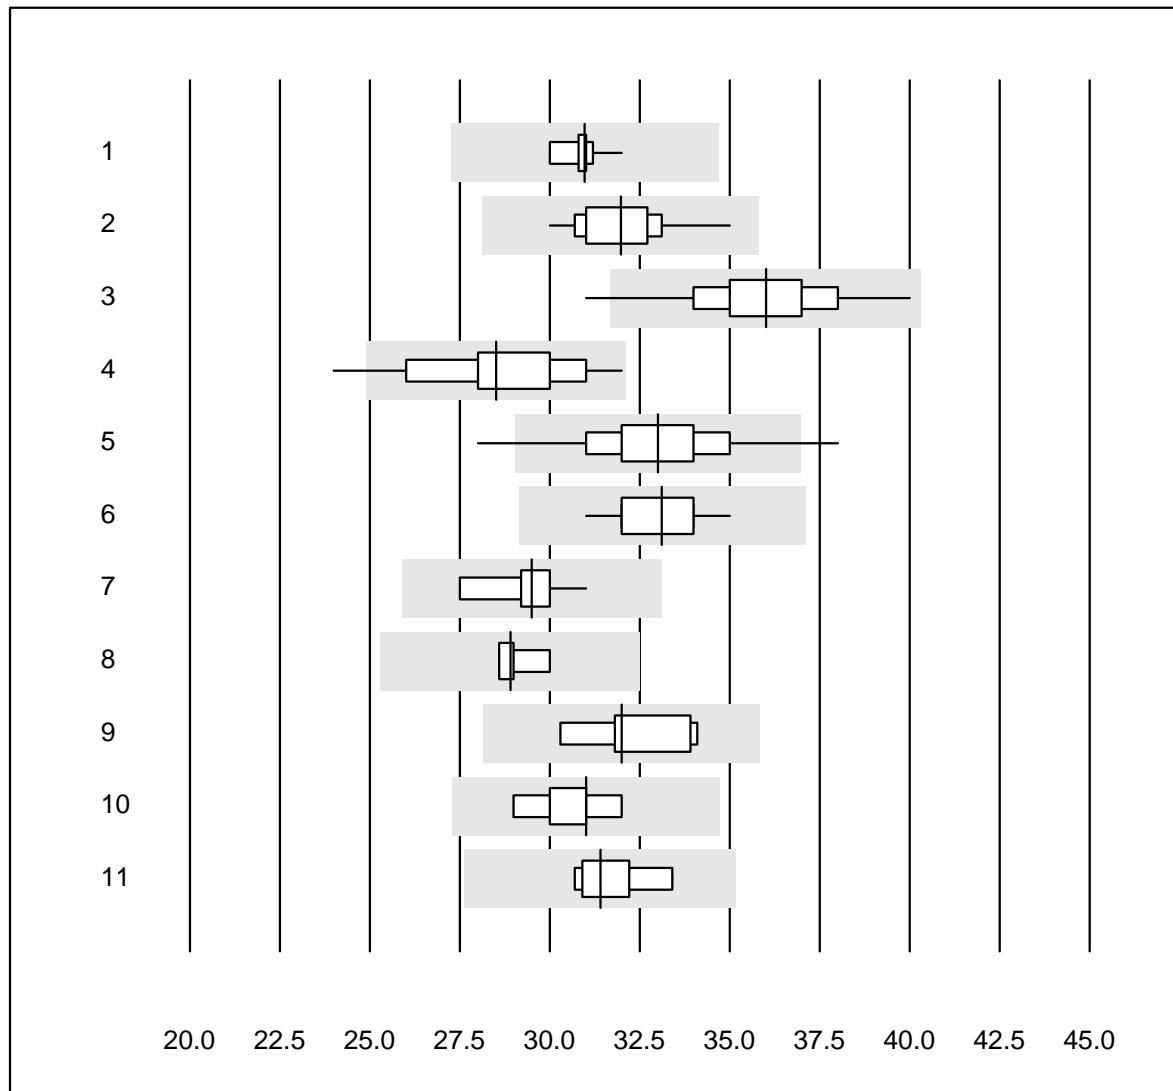


QUALAB Toleranz : 12 %  
( < 30: +/- 4 g/l)

Albumine (g/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	10	100.0	0.0	0.0	31	1.6	e
2	Cobas	23	100.0	0.0	0.0	32	3.5	e
3	Fuji Dri-Chem	222	99.0	0.5	0.5	36	4.2	e
4	Spotchem/Ready	29	96.6	3.4	0.0	29	6.6	e
5	Spotchem D-Concept	160	93.7	5.0	1.3	33	5.3	e
6	Piccolo	52	98.1	0.0	1.9	33	2.8	e
7	Beckmann	10	100.0	0.0	0.0	30	3.1	e
8	Dimension	4	100.0	0.0	0.0	29	2.1	e
9	Abx Mira	5	100.0	0.0	0.0	32	4.9	e*
10	Hitachi S40/M40	9	100.0	0.0	0.0	31	3.7	e
11	Autolyser/DiaSys	7	100.0	0.0	0.0	31	2.9	e

## Phosphatase alcaline

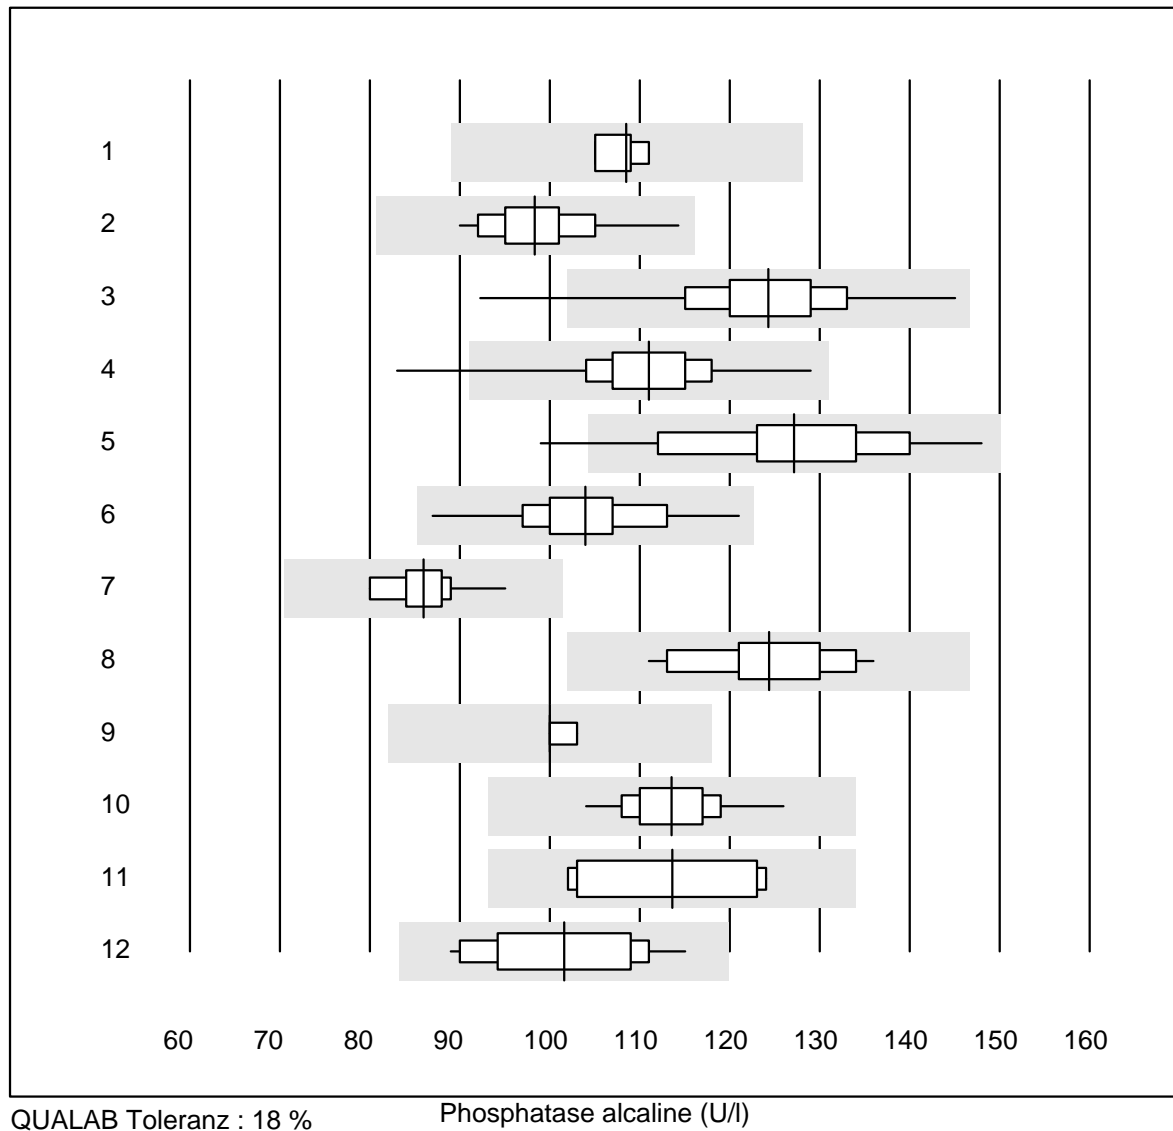

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	8	100.0	0.0	0.0	109	2.1	e
2 Cobas	24	100.0	0.0	0.0	98	5.8	e
3 Reflotron	459	98.7	1.1	0.2	124	6.2	e
4 Fuji Dri-Chem	818	98.9	0.4	0.7	111	5.2	e
5 Spotchem/Ready	55	96.4	3.6	0.0	127	8.4	e
6 Spotchem D-Concept	306	99.0	0.0	1.0	104	5.7	e
7 Hitachi S40/M40	14	100.0	0.0	0.0	86	4.6	e
8 Beckman	13	100.0	0.0	0.0	124	6.6	e
9 Dimension	4	100.0	0.0	0.0	100	1.5	e
10 Piccolo	44	100.0	0.0	0.0	114	4.0	e
11 Abx Mira	8	100.0	0.0	0.0	114	8.0	e*
12 Autolyser/DiaSys	18	94.4	0.0	5.6	102	7.8	e


# Amylase

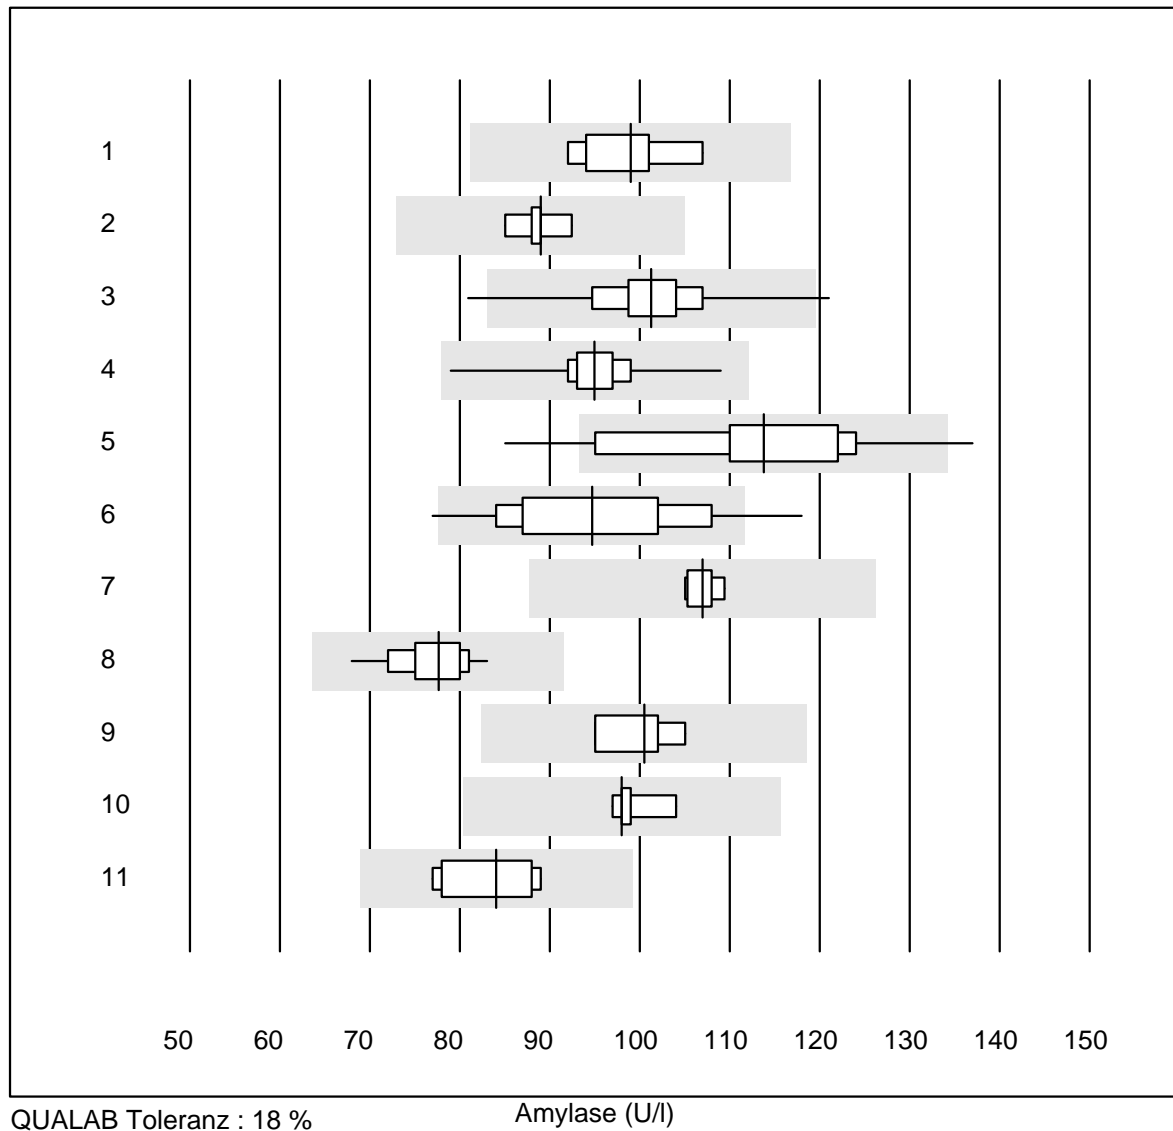

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	8	100.0	0.0	0.0	99	4.8	e
2 Cobas	8	100.0	0.0	0.0	89	2.4	e
3 Reflotron	117	95.7	1.7	2.6	101	5.6	e
4 Fuji Dri-Chem	608	99.8	0.0	0.2	95	3.4	e
5 Spotchem/Ready	42	85.7	11.9	2.4	114	10.3	e
6 Spotchem D-Concept	241	93.8	5.8	0.4	95	9.8	e
7 Architect	5	100.0	0.0	0.0	107	1.7	e
8 Piccolo	44	100.0	0.0	0.0	78	4.6	e
9 Abx Mira	4	100.0	0.0	0.0	101	4.3	e
10 Hitachi S40/M40	5	100.0	0.0	0.0	98	2.8	e
11 Autolyser/DiaSys	7	100.0	0.0	0.0	84	5.5	e




## Amylase pancréatique

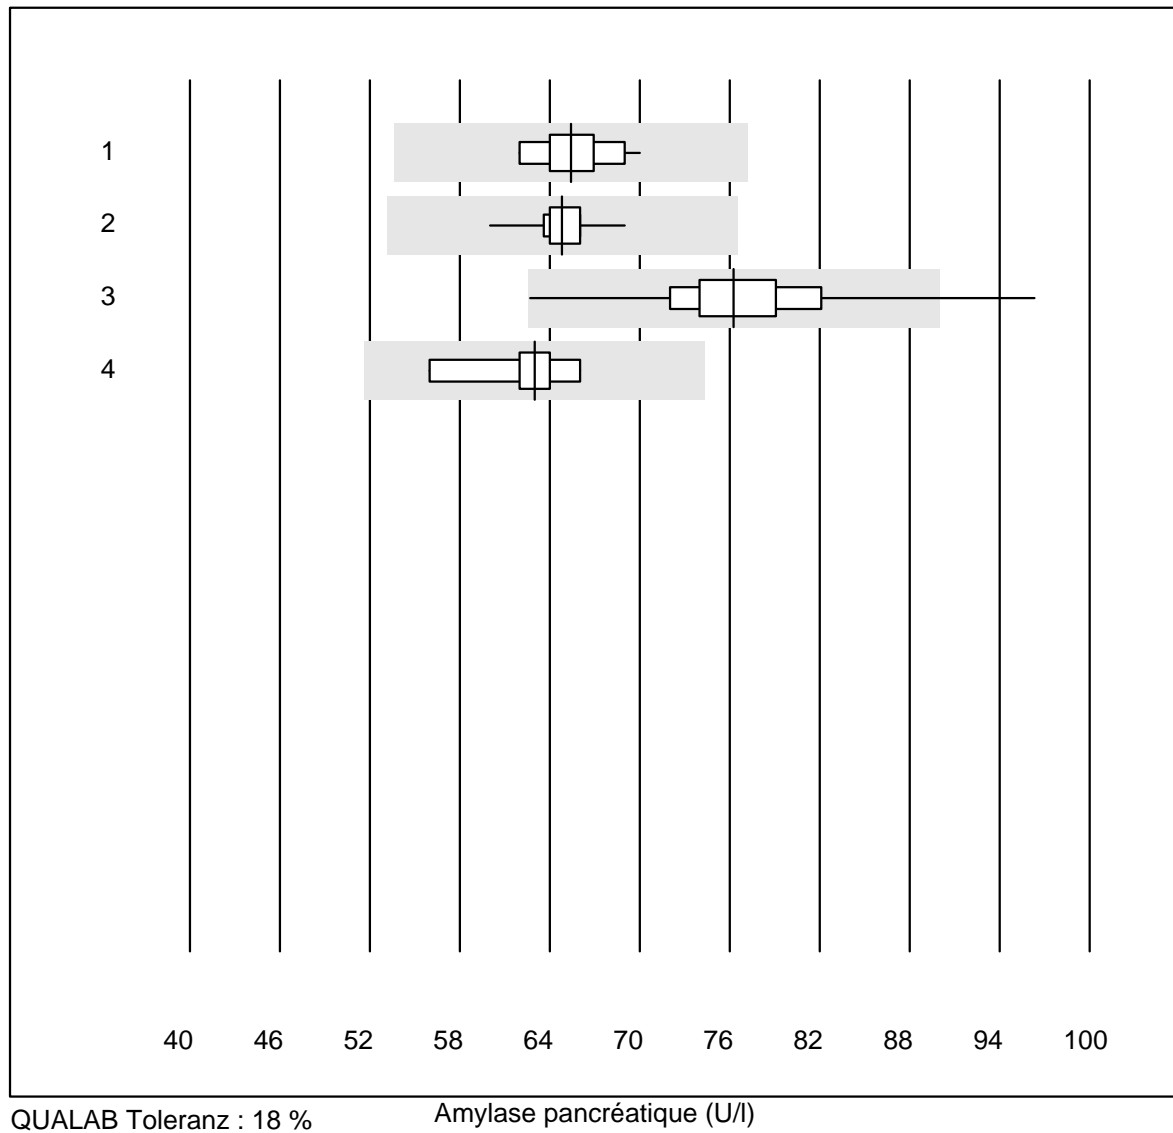

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	16	100.0	0.0	0.0	65	3.7	e
2 Cobas	14	100.0	0.0	0.0	65	3.0	e
3 Reflotron	316	96.5	1.6	1.9	76	5.7	e
4 Autolyser/DiaSys	9	100.0	0.0	0.0	63	4.6	e

## Bilirubine totale

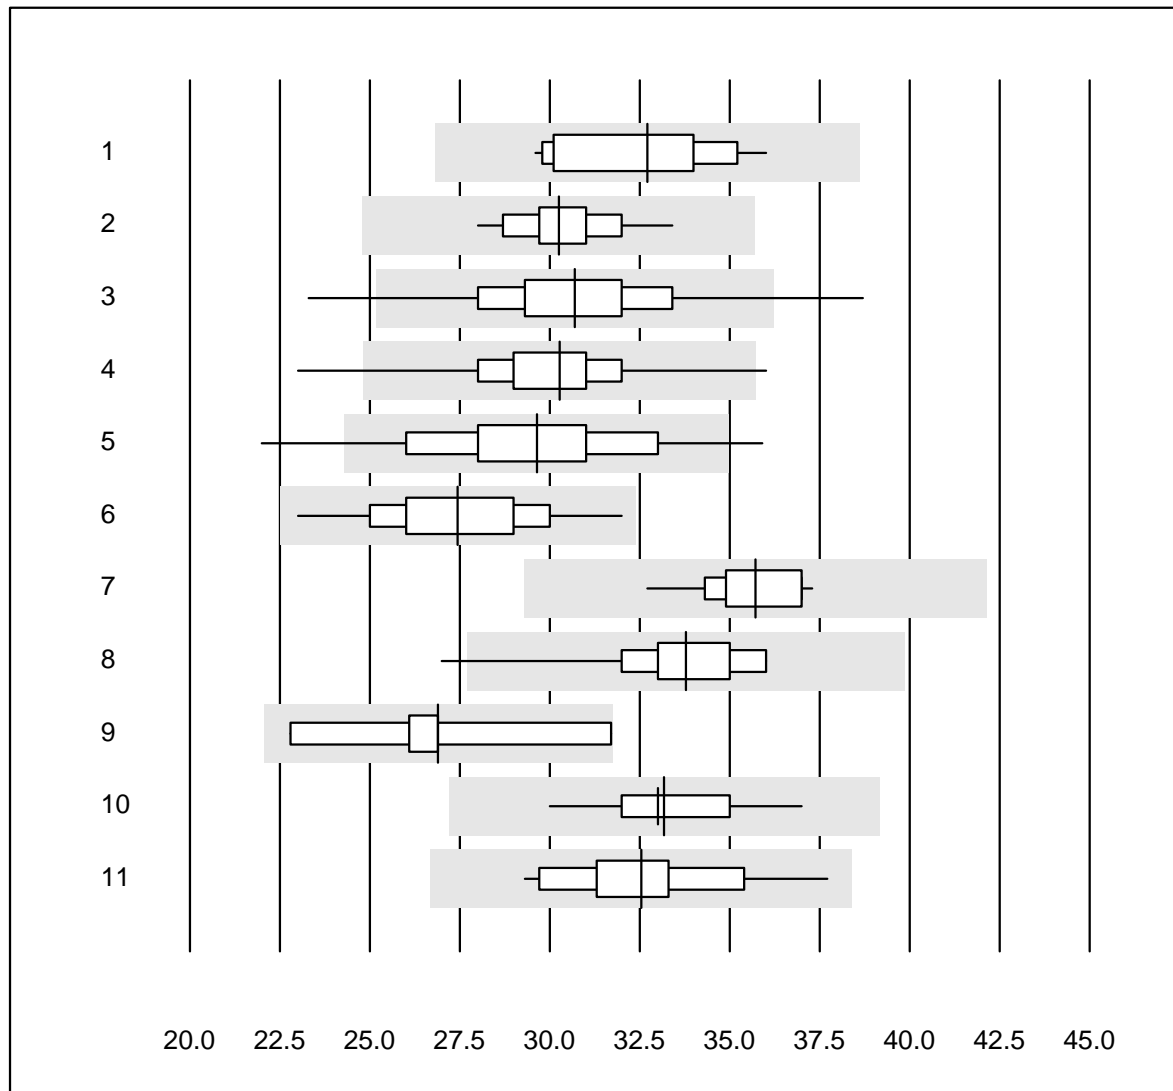


QUALAB Toleranz : 18 %

Bilirubine totale (µmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	12	100.0	0.0	0.0	32.7	6.6	e
2	Cobas	21	100.0	0.0	0.0	30.2	4.5	e
3	Reflotron	342	93.6	2.9	3.5	30.7	7.7	e
4	Fuji Dri-Chem	653	98.6	0.5	0.9	30.3	5.9	e
5	Spotchem/Ready	50	92.0	8.0	0.0	29.6	9.0	e
6	Spotchem D-Concept	242	99.6	0.0	0.4	27.4	6.5	e
7	Beckman	11	100.0	0.0	0.0	35.7	3.8	e
8	Piccolo	50	98.0	2.0	0.0	33.8	5.1	e
9	Abx Mira	9	88.9	0.0	11.1	26.9	9.1	e*
10	Hitachi S40/M40	11	100.0	0.0	0.0	33.2	5.2	e
11	Autolyser/DiaSys	16	100.0	0.0	0.0	32.5	6.4	e

## Bilirubine directe

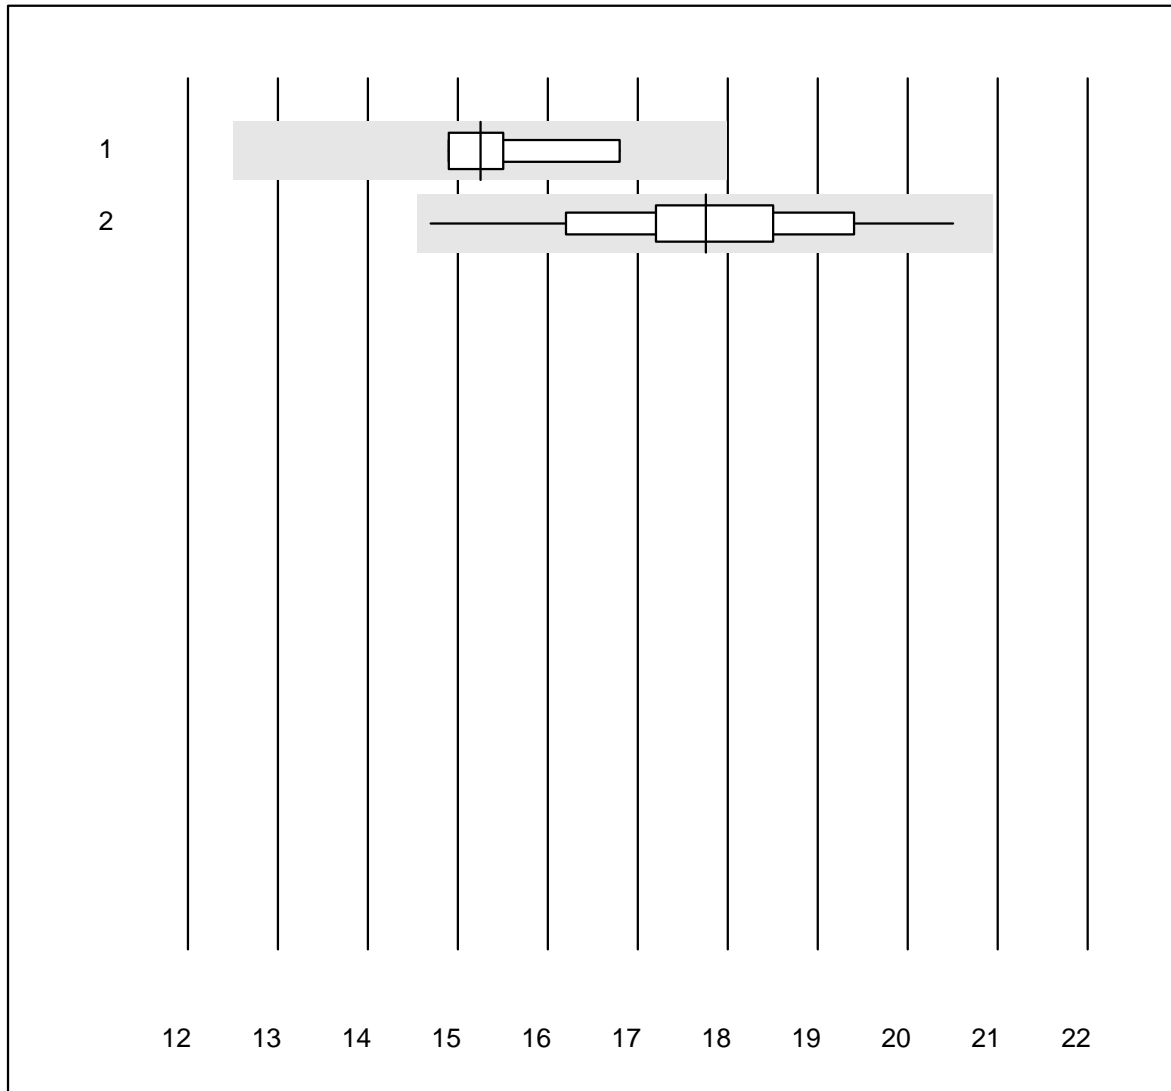


Tolérance MQ : 18 %

Bilirubine directe (µmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Autolyser/DiaSys	4	100.0	0.0	0.0	15.3	5.6	e*
2	Fuji Dri-Chem	26	100.0	0.0	0.0	17.8	7.2	e

# Calcium

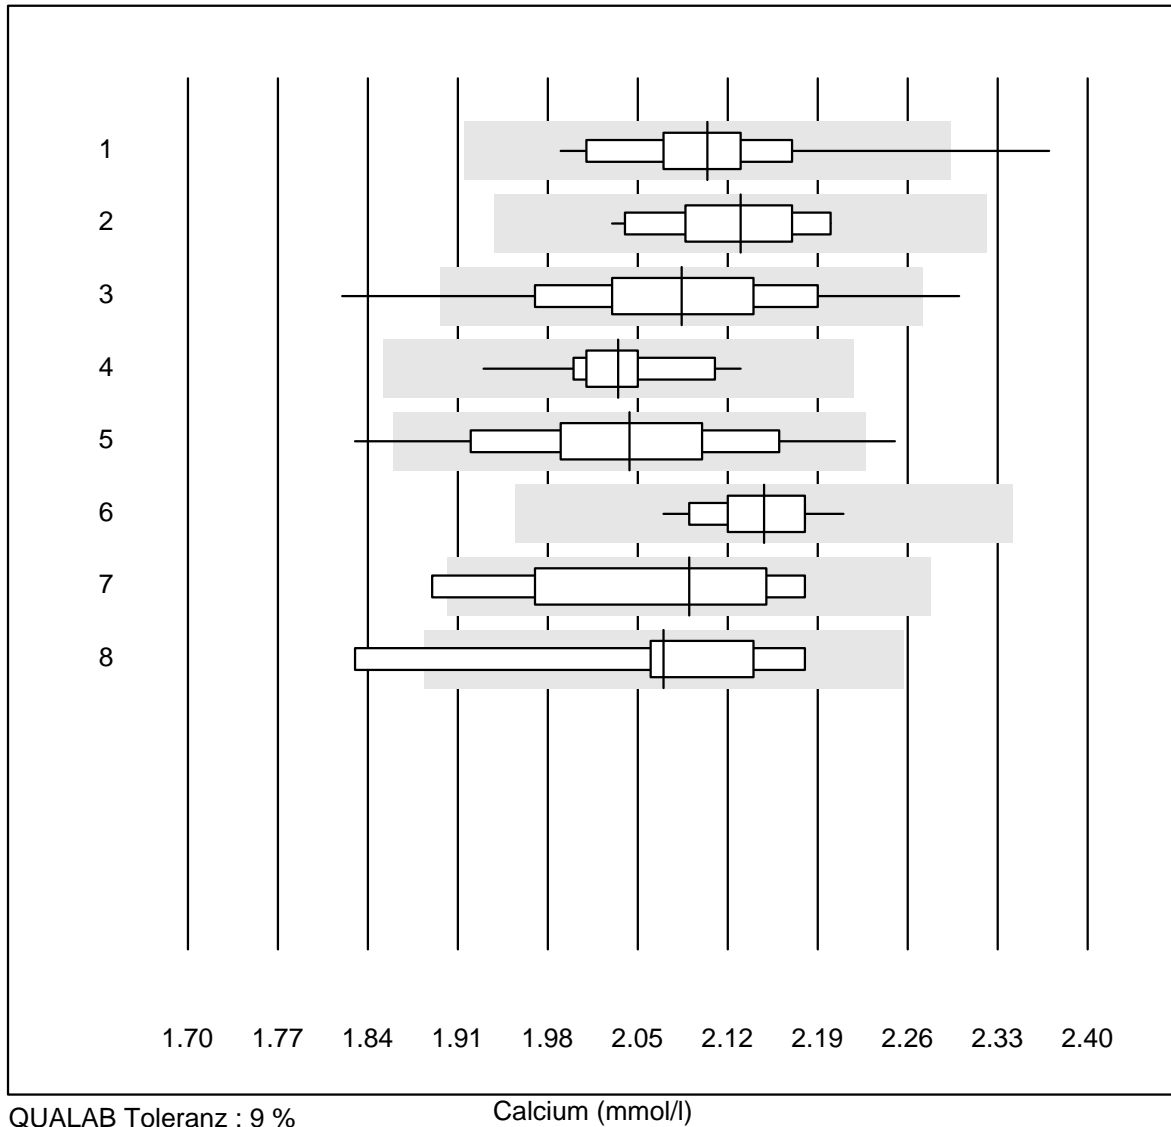


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	27	96.3	3.7	0.0	2.10	3.4	e
2	Cobas	24	100.0	0.0	0.0	2.13	2.6	e
3	Fuji Dri-Chem	357	96.6	2.8	0.6	2.08	4.1	e
4	Spotchem/Ready	17	100.0	0.0	0.0	2.03	2.2	e
5	Spotchem D-Concept	95	93.7	2.1	4.2	2.04	4.3	e
6	Piccolo	47	97.9	0.0	2.1	2.15	1.7	e
7	Hitachi S40/M40	9	88.9	11.1	0.0	2.09	5.3	e*
8	Autolyser/DiaSys	9	88.9	11.1	0.0	2.07	5.2	e*

## Calcium ISE

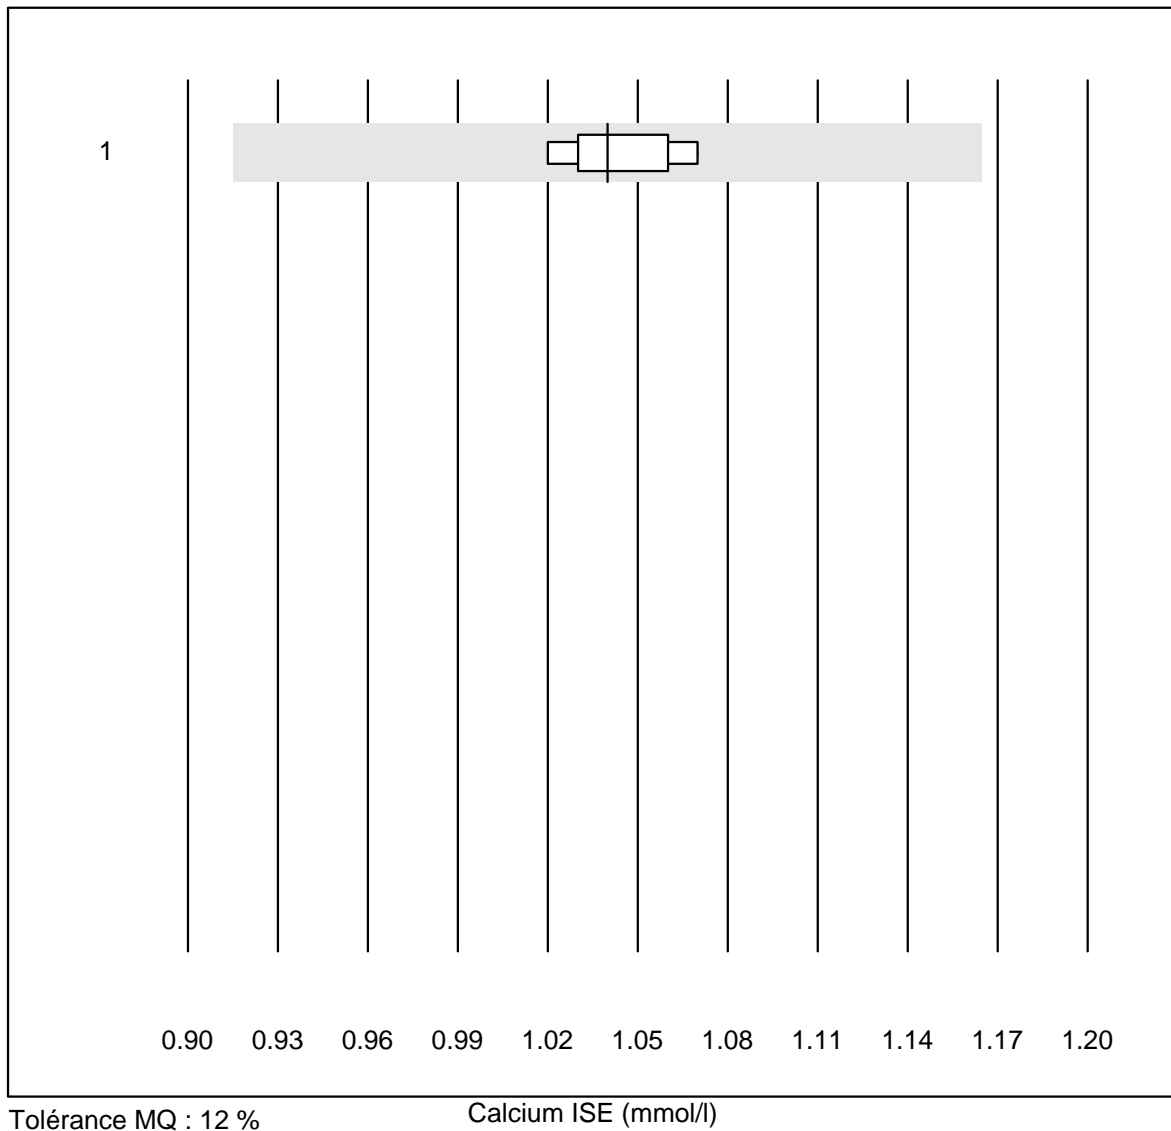

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	iStat Chem8	5	100.0	0.0	0.0	1.04	2.0	e

# Chlorures

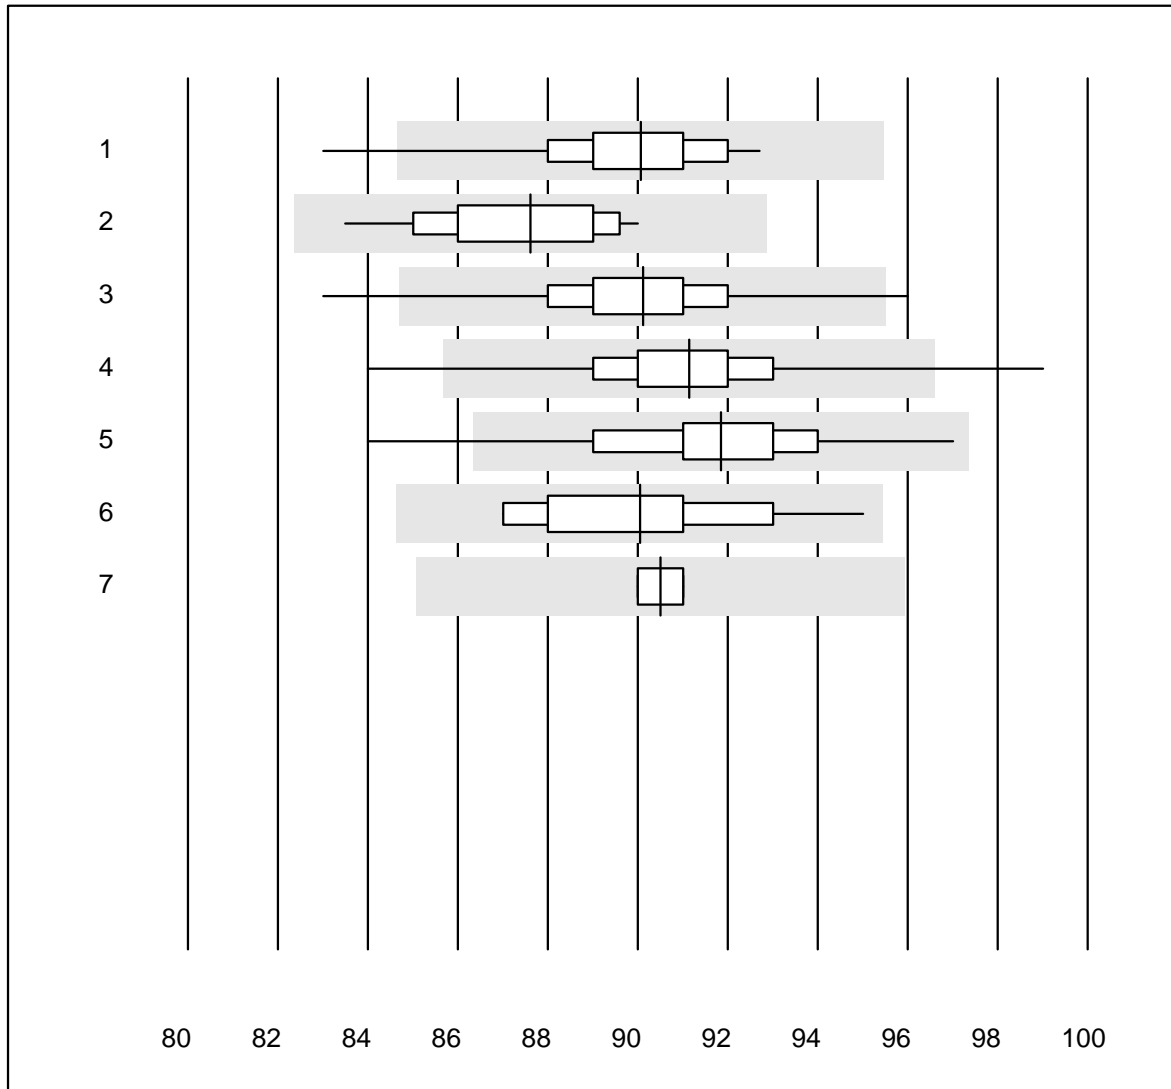


QUALAB Toleranz : 6 %

Chlorures (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 ISE	28	96.4	3.6	0.0	90	2.2	e
2 Cobas	14	100.0	0.0	0.0	88	2.2	e
3 Fuji Dri-Chem	751	98.7	0.8	0.5	90	1.8	e
4 Spotchem D-Concept	280	98.2	0.7	1.1	91	2.0	e
5 Spotchem EL-SE 1520	65	95.4	1.5	3.1	92	2.4	e
6 Piccolo	22	100.0	0.0	0.0	90	2.4	e
7 iStat Chem8	4	100.0	0.0	0.0	91	0.6	e

## Cholestérol

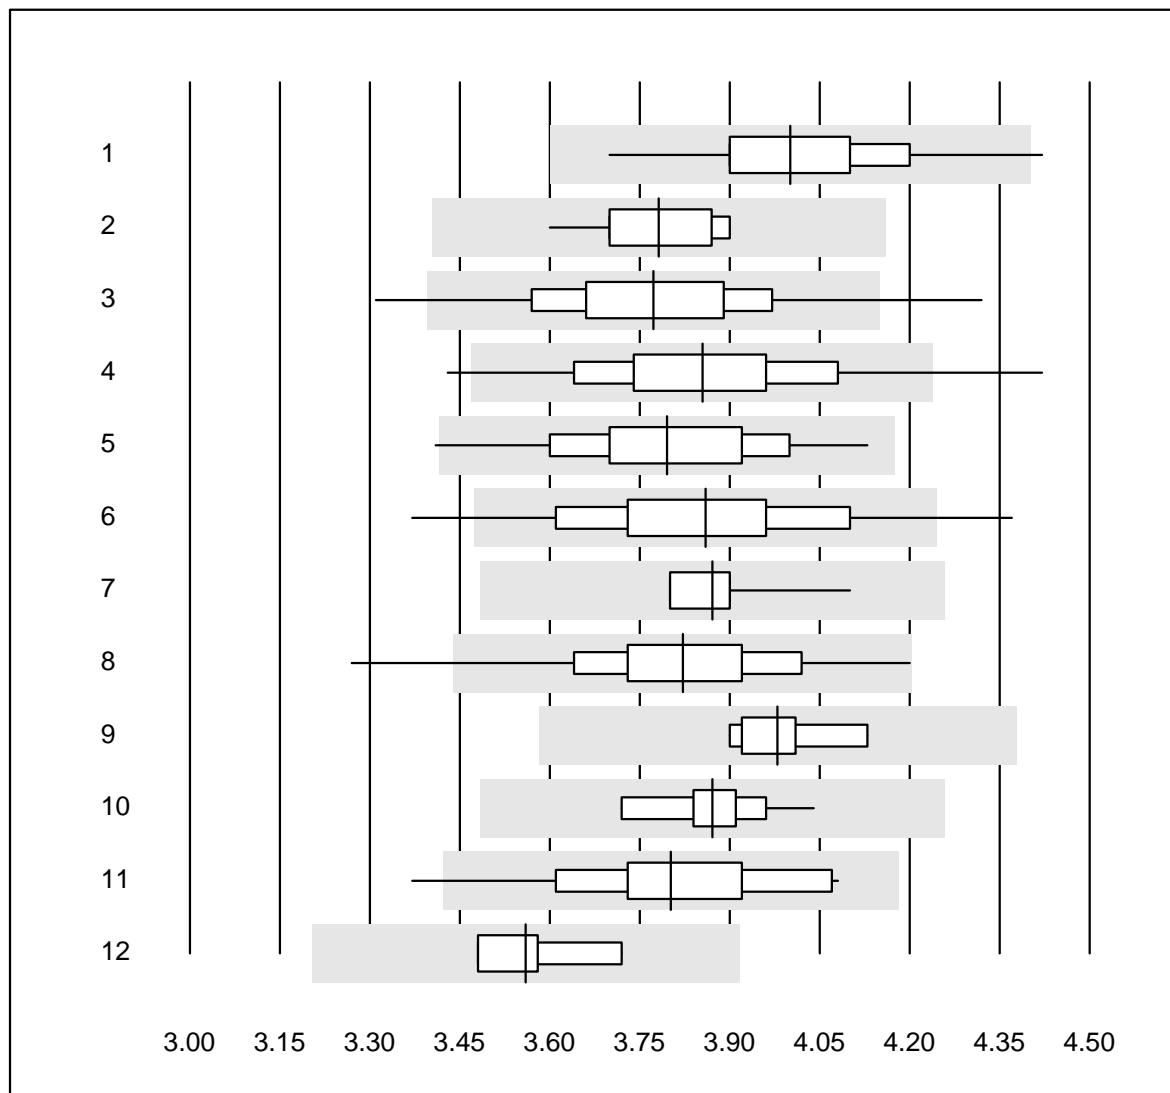


QUALAB Toleranz : 10 %

Cholestérol (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	28	89.3	3.6	7.1	4.00	3.8	e
2	Cobas	22	95.5	0.0	4.5	3.78	2.6	e
3	Reflotron	383	98.4	0.8	0.8	3.77	4.2	e
4	Fuji Dri-Chem	803	96.9	2.2	0.9	3.85	4.4	e
5	Spotchem/Ready	73	94.5	1.4	4.1	3.80	4.2	e
6	Spotchem D-Concept	306	95.7	2.3	2.0	3.86	4.7	e
7	Piccolo	22	100.0	0.0	0.0	3.87	2.0	e
8	Cholestech LDX	311	97.4	1.0	1.6	3.82	3.9	e
9	Abx Mira	7	85.7	0.0	14.3	3.98	2.1	e
10	Hitachi S40/M40	10	100.0	0.0	0.0	3.87	2.4	e
11	Autolyser/DiaSys	18	94.4	5.6	0.0	3.80	4.5	e
12	Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	3.56	2.8	e*

## Cholestérol HDL

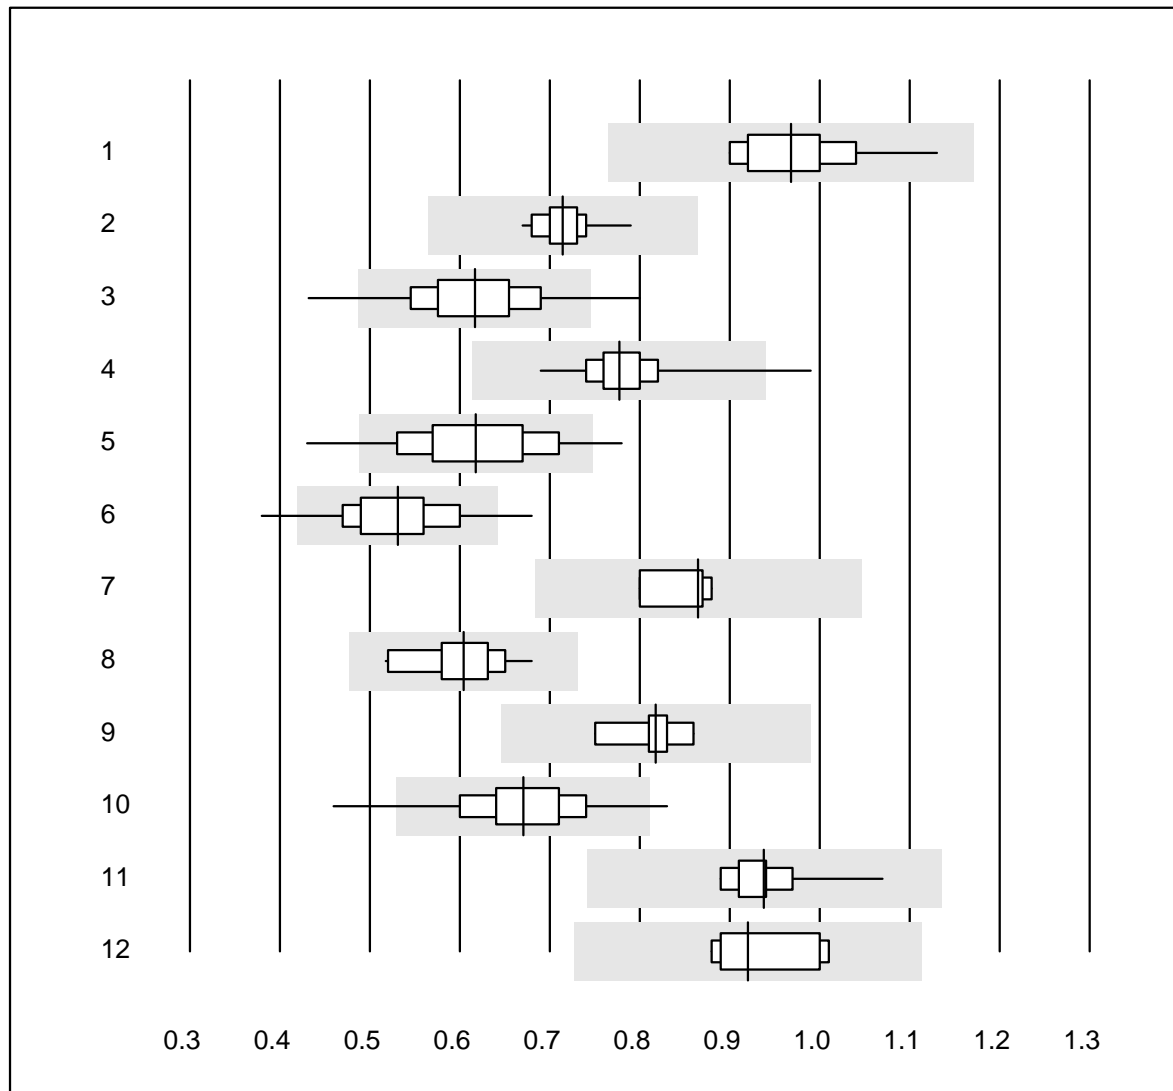


QUALAB Toleranz : 21 %

Cholestérol HDL (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	humide, direct	14	100.0	0.0	0.0	0.97	6.6	e
2	Cobas	20	100.0	0.0	0.0	0.71	3.8	e
3	Reflotron	274	90.9	3.6	5.5	0.62	9.8	e
4	Fuji Dri-Chem	778	98.3	0.4	1.3	0.78	4.4	e
5	Spotchem/Ready	67	94.0	6.0	0.0	0.62	11.7	e
6	Spotchem D-Concept	296	96.3	2.7	1.0	0.53	9.9	e
7	Dimension	4	100.0	0.0	0.0	0.87	4.2	e
8	Piccolo	20	100.0	0.0	0.0	0.60	7.1	e
9	Pentra/Selectra	10	90.0	0.0	10.0	0.82	3.9	e
10	Cholestech LDX	312	95.2	3.2	1.6	0.67	9.0	e
11	Hitachi S40/M40	10	100.0	0.0	0.0	0.94	5.5	e
12	Architect	6	100.0	0.0	0.0	0.92	6.0	e
13	Autolyser/DiaSys	18	94.4	5.6	0.0	0.87	8.3	e



## Créatine-kinase

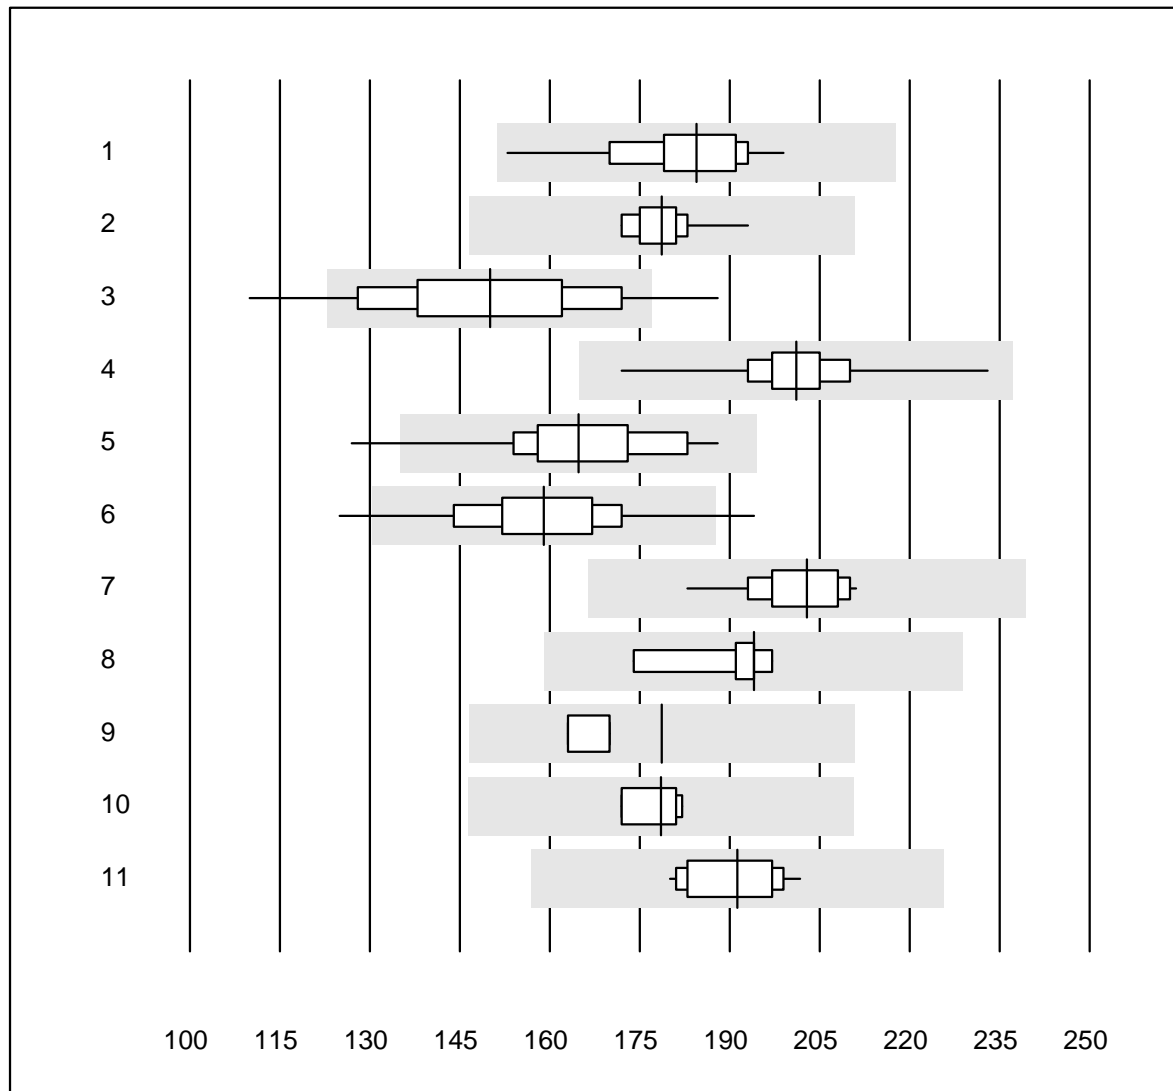


QUALAB Toleranz : 18 %

Créatine-kinase (U/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	22	100.0	0.0	0.0	184	5.7	e
2 Cobas	20	100.0	0.0	0.0	179	2.8	e
3 Reflotron	305	79.7	11.1	9.2	150	11.3	e
4 Fuji Dri-Chem	541	99.3	0.0	0.7	201	3.7	e
5 Spotchem/Ready	32	93.7	6.3	0.0	165	8.6	e
6 Spotchem D-Concept	190	96.8	1.6	1.6	159	7.1	e
7 Piccolo	17	88.2	0.0	11.8	203	3.9	e
8 Abx Mira	5	100.0	0.0	0.0	194	4.8	e*
9 Hitachi S40/M40	4	50.0	0.0	50.0	179	3.0	a
10 Dimension	4	100.0	0.0	0.0	179	2.6	e
11 Autolyser/DiaSys	15	100.0	0.0	0.0	191	3.6	e

## Cholésterol LDL

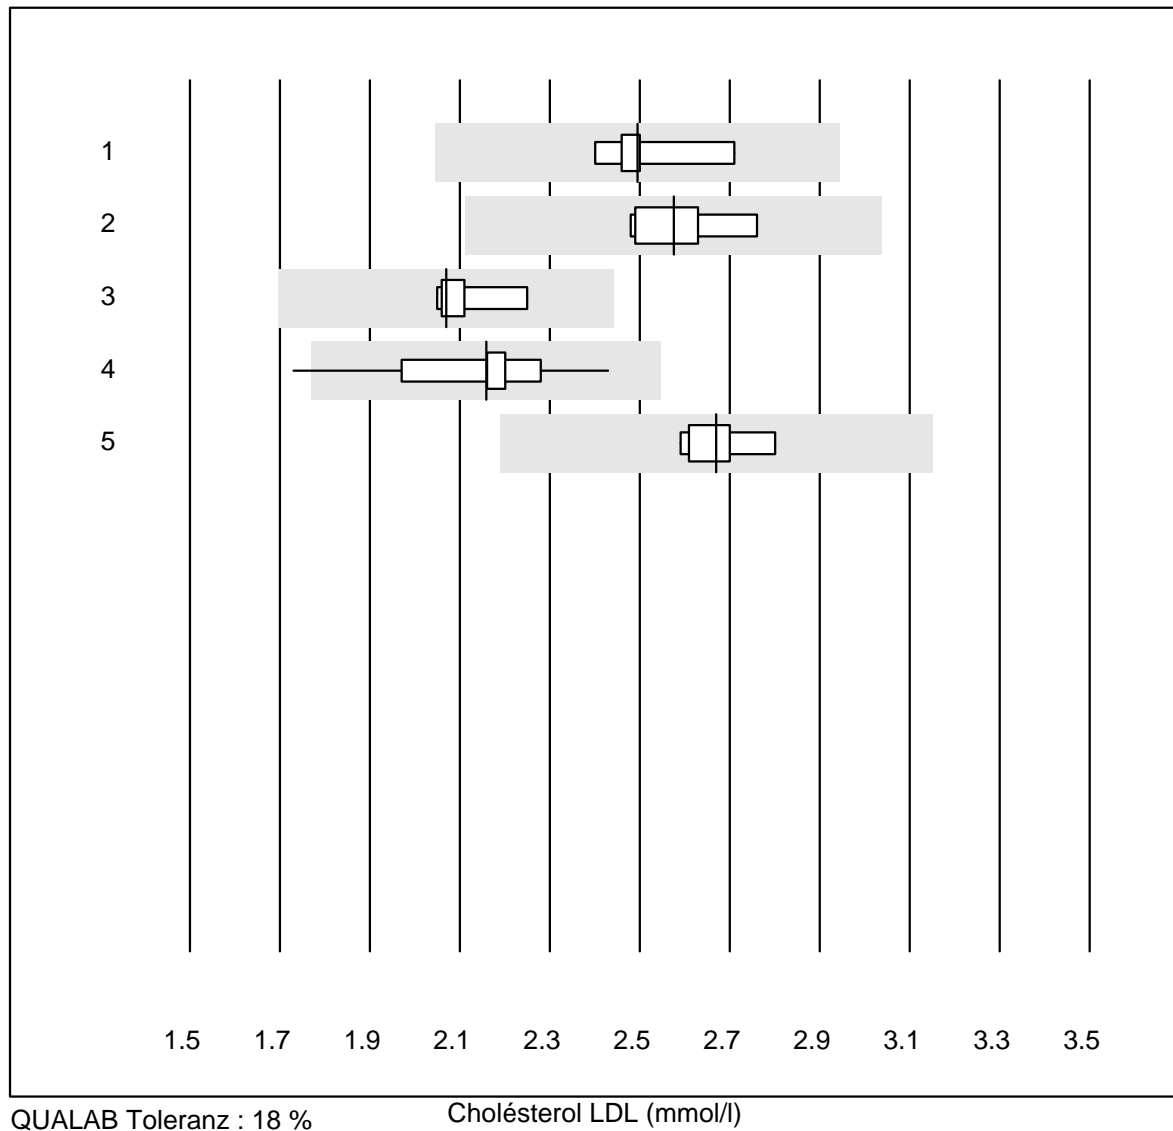


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	10	90.0	0.0	10.0	2.5	3.6	e
2	Roche, Cobas	8	100.0	0.0	0.0	2.6	4.0	e
3	Hitachi S40/M40	5	100.0	0.0	0.0	2.1	3.9	e
4	Autolyser/DiaSys	13	92.3	7.7	0.0	2.2	7.6	e
5	Beckman	8	100.0	0.0	0.0	2.7	3.0	e

# Fer

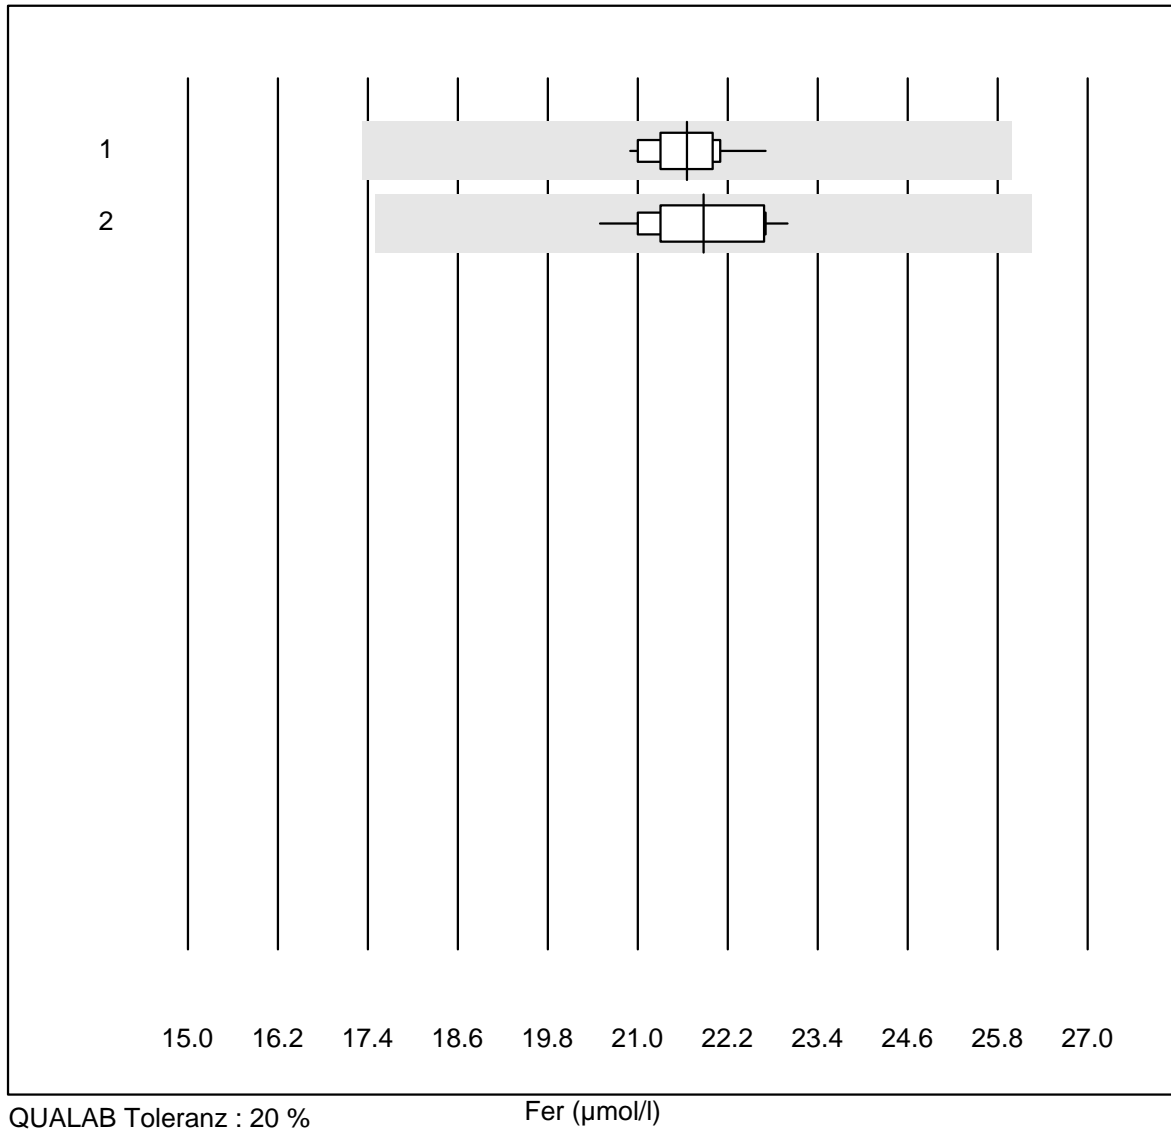


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	15	100.0	0.0	0.0	22	2.3	e
2	Cobas	11	100.0	0.0	0.0	22	3.5	e

## Gamma-GT

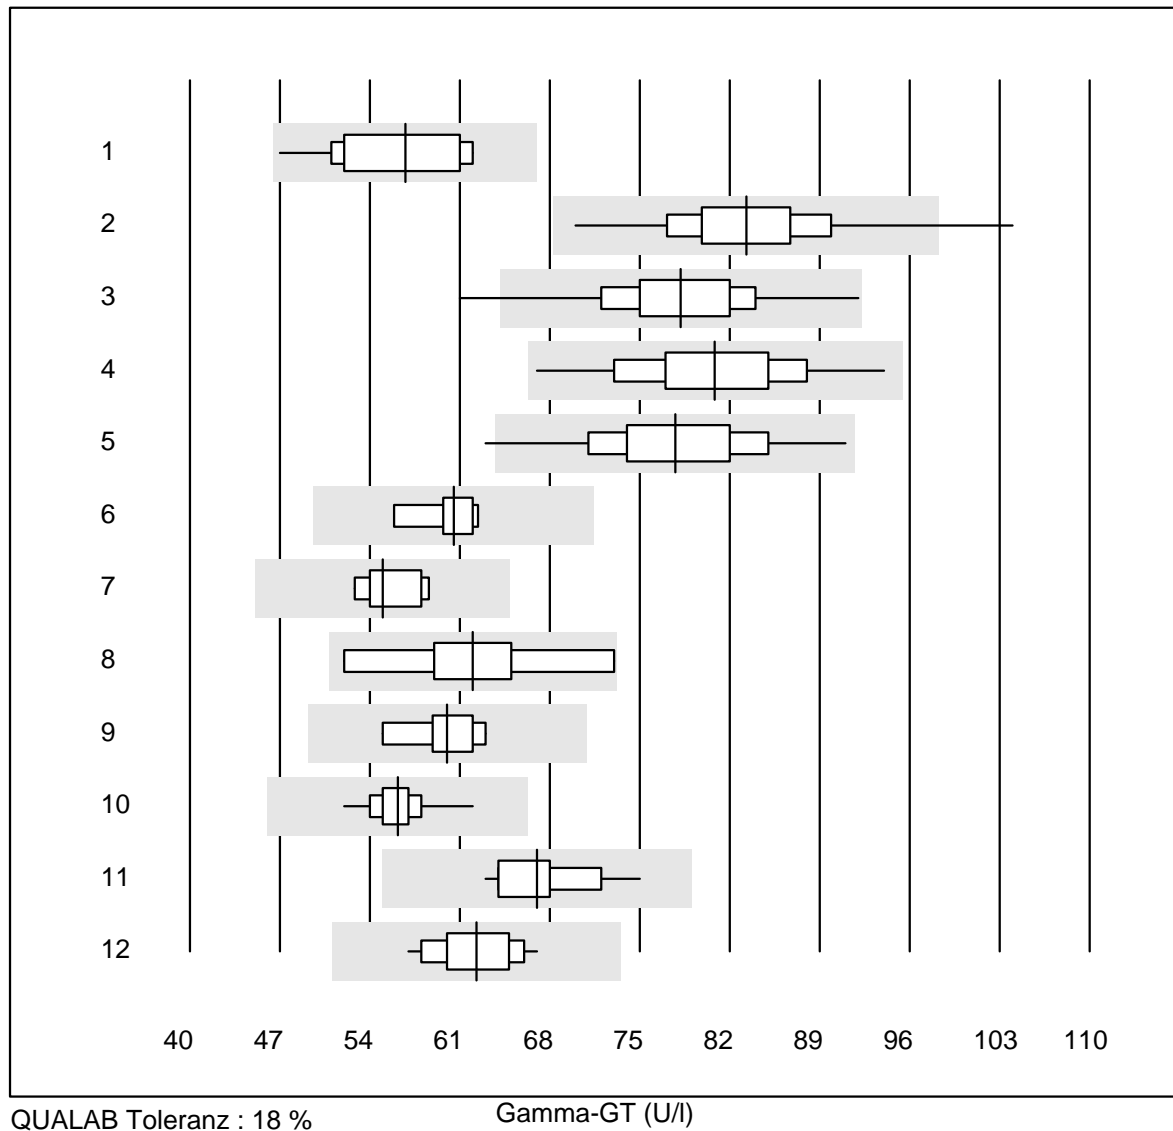


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	23	100.0	0.0	0.0	57	8.1	e
2 Reflotron	604	97.7	1.0	1.3	83	6.3	e
3 Fuji Dri-Chem	897	99.5	0.2	0.3	78	5.7	e
4 Spotchem/Ready	82	98.8	0.0	1.2	81	7.2	e
5 Spotchem D-Concept	341	98.8	0.3	0.9	78	6.7	e
6 Selectra/Biolis	6	100.0	0.0	0.0	61	3.9	e
7 Architect	6	100.0	0.0	0.0	55	4.1	e
8 Dimension	9	100.0	0.0	0.0	62	9.2	e*
9 IFCC Beckmann	7	100.0	0.0	0.0	60	4.5	e
10 Piccolo	41	100.0	0.0	0.0	56	2.9	e
11 Hitachi S40/M40	13	100.0	0.0	0.0	67	5.2	e
12 Autolyser/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	62	4.6	e

# Glucose

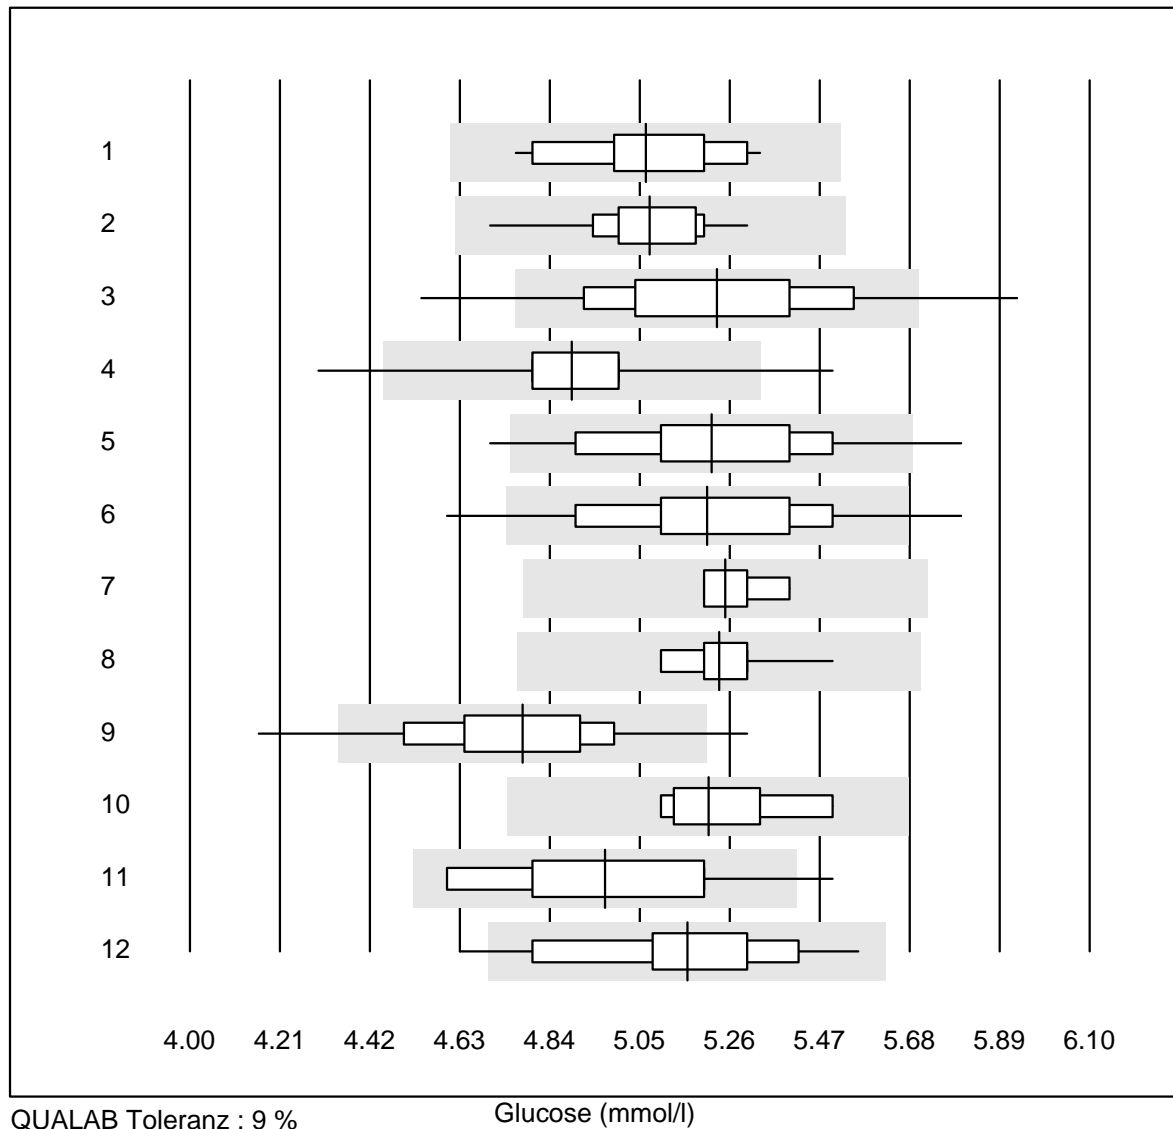


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	28	96.4	0.0	3.6	5.1	3.1	e
2	Cobas	22	100.0	0.0	0.0	5.1	2.6	e
3	Reflotron	598	92.0	6.5	1.5	5.2	4.7	e
4	Fuji Dri-Chem	847	98.9	0.4	0.7	4.9	2.5	e
5	Spotchem/Ready	73	90.5	6.8	2.7	5.2	4.4	e
6	Spotchem D-Concept	319	95.3	4.1	0.6	5.2	4.2	e
7	Dimension	4	100.0	0.0	0.0	5.3	1.8	e
8	Piccolo	54	100.0	0.0	0.0	5.2	1.6	e
9	Cholestech LDX	299	96.0	2.7	1.3	4.8	4.1	e
10	Abx Mira	7	100.0	0.0	0.0	5.2	2.7	e
11	Hitachi S40/M40	15	93.3	6.7	0.0	5.0	5.0	e*
12	Autolyser/DiaSys	18	94.4	5.6	0.0	5.2	4.1	e
13	iStat Chem8	6	100.0	0.0	0.0	4.7	0.9	e

## Glucose

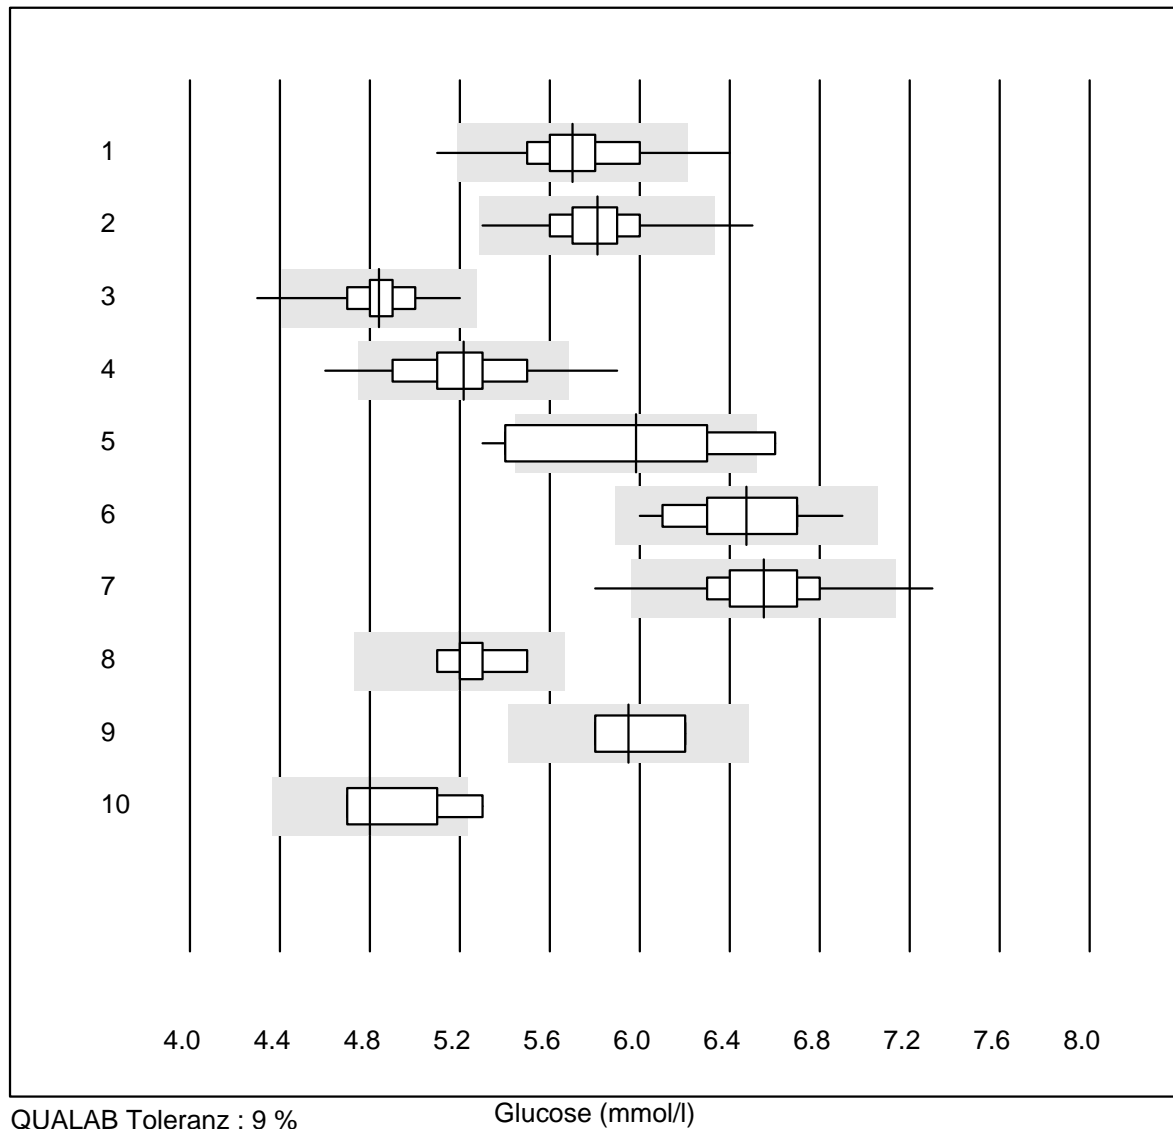


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Accu-Chek Aviva	304	97.1	1.6	1.3	5.7	3.4	e
2	Accu-Chek Inform 2	689	98.9	0.7	0.4	5.8	2.7	e
3	Accu-Check Guide	184	99.0	0.5	0.5	4.8	2.6	e
4	Contour XT	1252	97.1	2.4	0.5	5.2	4.0	e
5	Glucocard	12	50.0	50.0	0.0	6.0	8.1	e*
6	Hemocue 201+ P-equiv	97	97.9	0.0	2.1	6.5	3.5	e
7	Hemocue 201RT P-equiv	110	92.8	2.7	4.5	6.6	3.6	e
8	Freestyle Freedom li	5	100.0	0.0	0.0	5.2	2.9	e*
9	Sanofi BG Star	4	75.0	0.0	25.0	6.0	3.5	e*
10	Contour NEXT ONE	7	85.7	14.3	0.0	4.8	4.8	e*

## Glucose

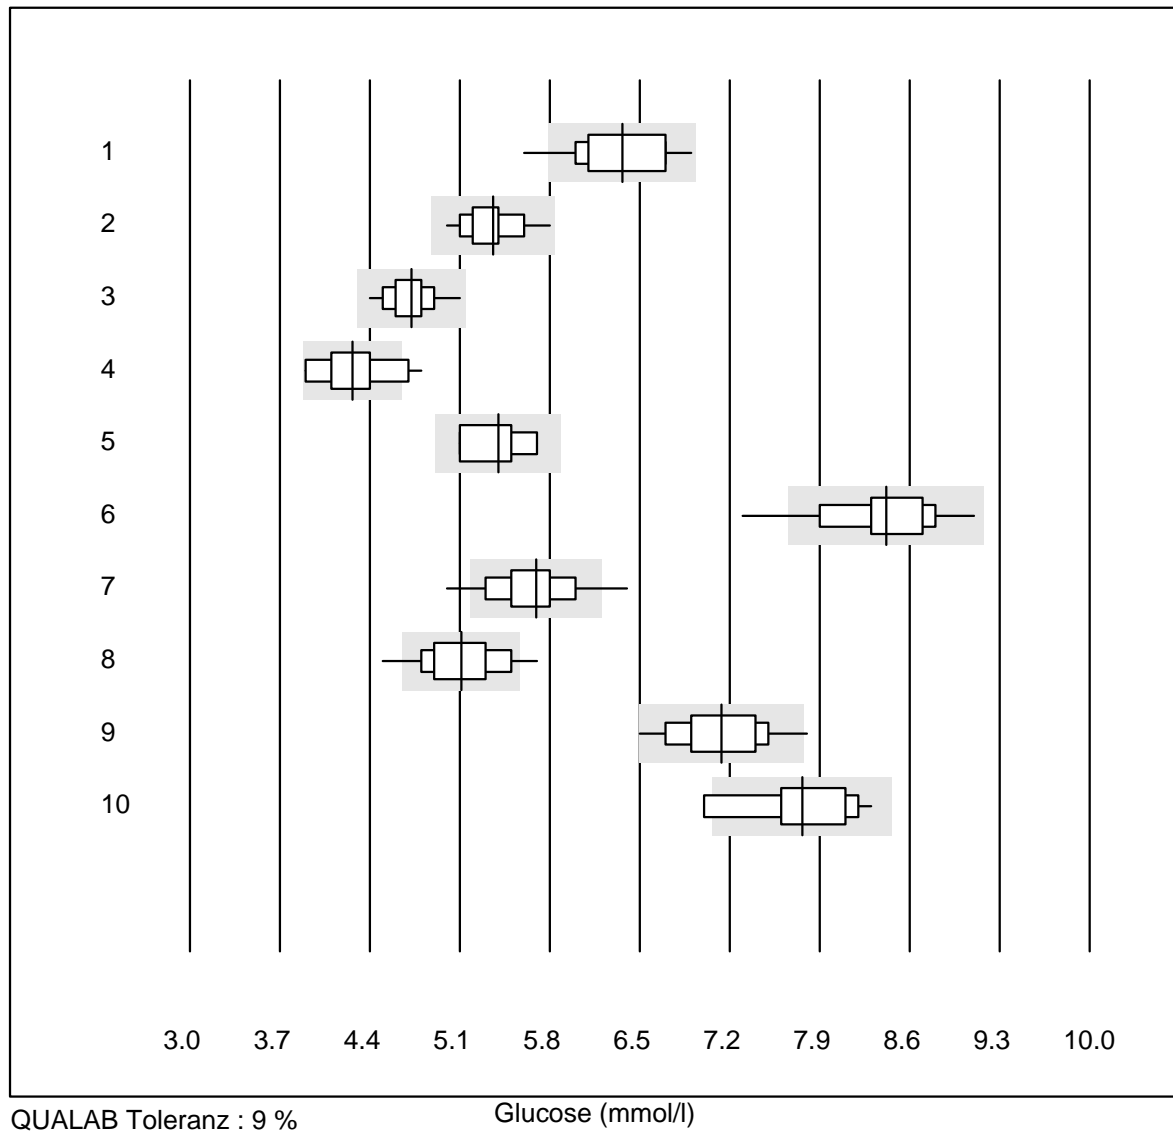

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Hemocue 201+ (alt)	43	95.3	4.7	0.0	6.4	4.9	e
2	AccuChek Sensor	31	96.8	0.0	3.2	5.4	3.4	e
3	OneTouch Verio	26	96.2	0.0	3.8	4.7	3.6	e
4	Contour 2 (5s)	21	80.9	14.3	4.8	4.3	6.4	e*
5	Contour (15s)	5	80.0	0.0	20.0	5.4	4.6	e*
6	Healthpro	37	91.9	5.4	2.7	8.4	4.7	e
7	Mylife UNIO	260	95.0	4.2	0.8	5.7	4.6	e
8	mylife Pura	71	85.9	11.3	2.8	5.1	5.2	e
9	Omnitest	24	87.5	4.2	8.3	7.1	4.7	e
10	Alpha Check	22	81.8	9.1	9.1	7.8	5.2	e*

## Acide urique

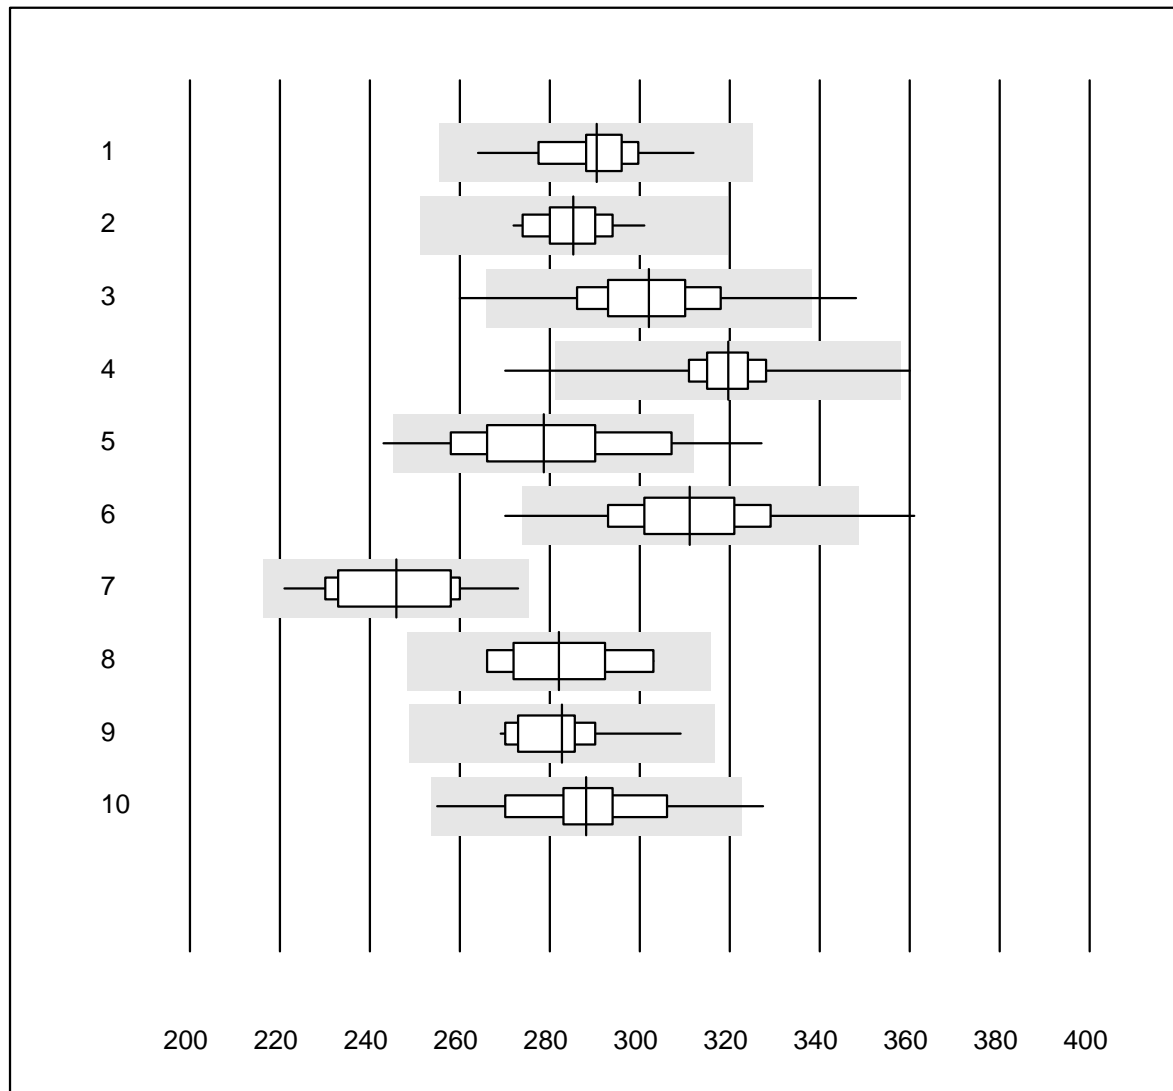


QUALAB Toleranz : 12 %

Acide urique (µmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	29	100.0	0.0	0.0	290	3.1	e
2	Cobas	20	100.0	0.0	0.0	285	2.7	e
3	Reflotron	527	96.8	1.7	1.5	302	4.5	e
4	Fuji Dri-Chem	834	99.3	0.5	0.2	320	2.5	e
5	Spotchem/Ready	63	92.1	7.9	0.0	279	7.0	e
6	Spotchem D-Concept	322	98.8	0.9	0.3	311	4.6	e
7	Piccolo	26	100.0	0.0	0.0	246	5.4	e
8	Abx Mira	7	85.7	0.0	14.3	282	4.9	e*
9	Hitachi S40/M40	13	100.0	0.0	0.0	283	3.7	e
10	Autolyser/DiaSys	17	94.1	5.9	0.0	288	5.6	e




# Urée

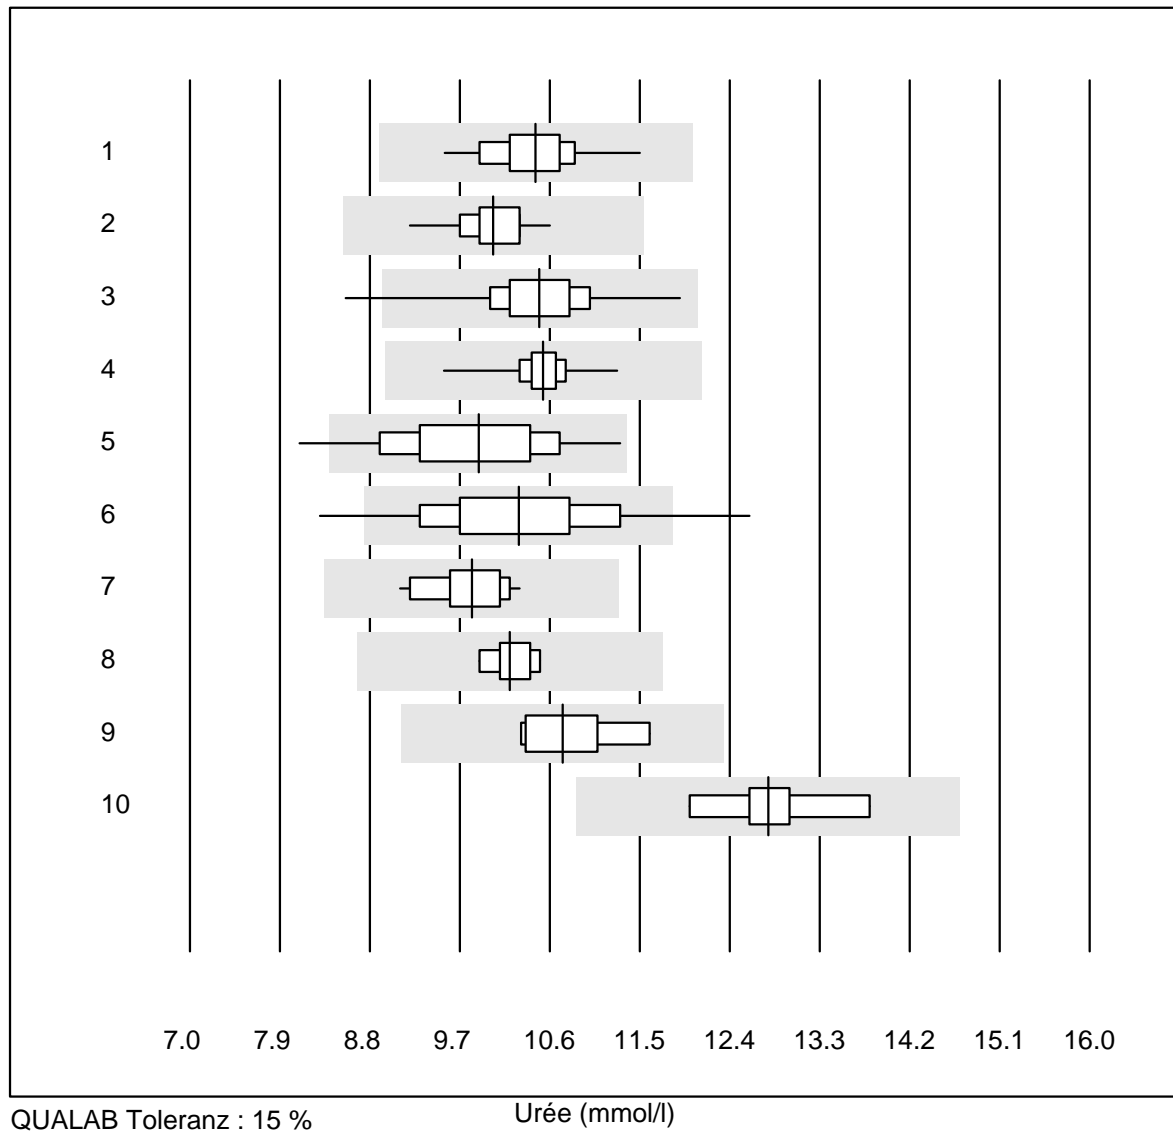

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	26	100.0	0.0	0.0	10.5	4.1	e
2	Cobas	23	100.0	0.0	0.0	10.0	3.3	e
3	Reflotron	239	97.5	0.4	2.1	10.5	4.3	e
4	Fuji Dri-Chem	498	100.0	0.0	0.0	10.5	1.8	e
5	Spotchem/Ready	42	95.2	2.4	2.4	9.9	7.4	e
6	Spotchem D-Concept	197	94.4	4.1	1.5	10.3	7.7	e
7	Piccolo	49	95.9	0.0	4.1	9.8	3.2	e
8	Hitachi S40/M40	9	100.0	0.0	0.0	10.2	2.1	e
9	Autolyser/DiaSys	14	100.0	0.0	0.0	10.7	4.4	e
10	iStat Chem8	5	100.0	0.0	0.0	12.8	5.1	e*

# Potassium

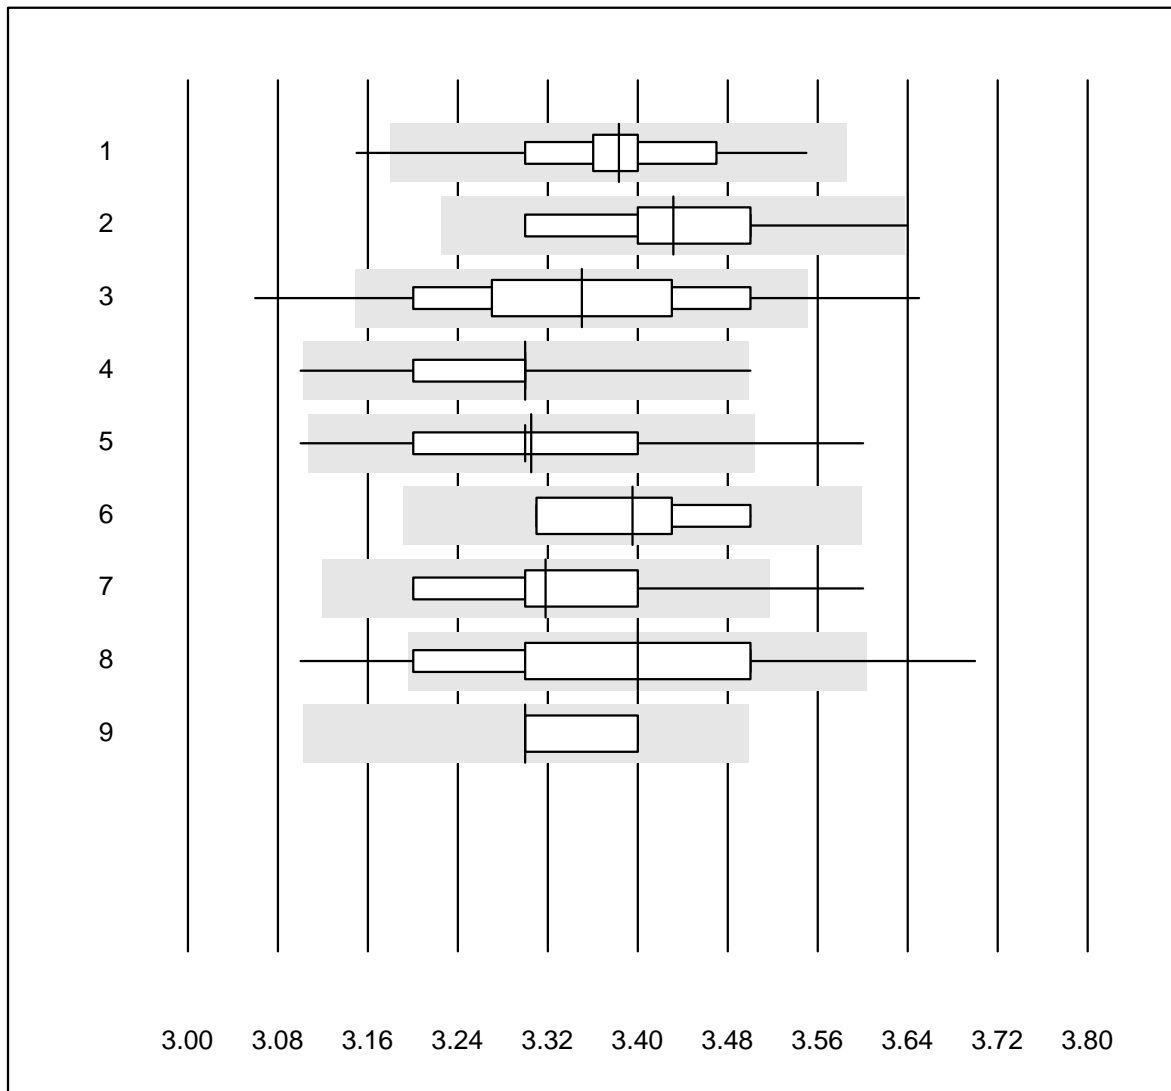


QUALAB Toleranz : 6 %

Potassium (mmol/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 ISE	41	97.6	2.4	0.0	3.38	2.0	e
2 Cobas	23	95.7	4.3	0.0	3.43	2.3	e
3 Reflotron	540	89.3	7.0	3.7	3.35	3.4	e
4 Fuji Dri-Chem	881	96.2	2.3	1.5	3.30	1.6	e
5 Spotchem D-Concept	324	98.8	0.9	0.3	3.31	1.9	e
6 Autolyser/DiaSys	4	100.0	0.0	0.0	3.40	2.4	e*
7 Spotchem EL-SE 1520	72	97.2	1.4	1.4	3.32	2.2	e
8 Piccolo	36	80.6	8.3	11.1	3.40	4.3	e
9 iStat Chem8	7	85.7	0.0	14.3	3.30	1.5	e

## Créatinine

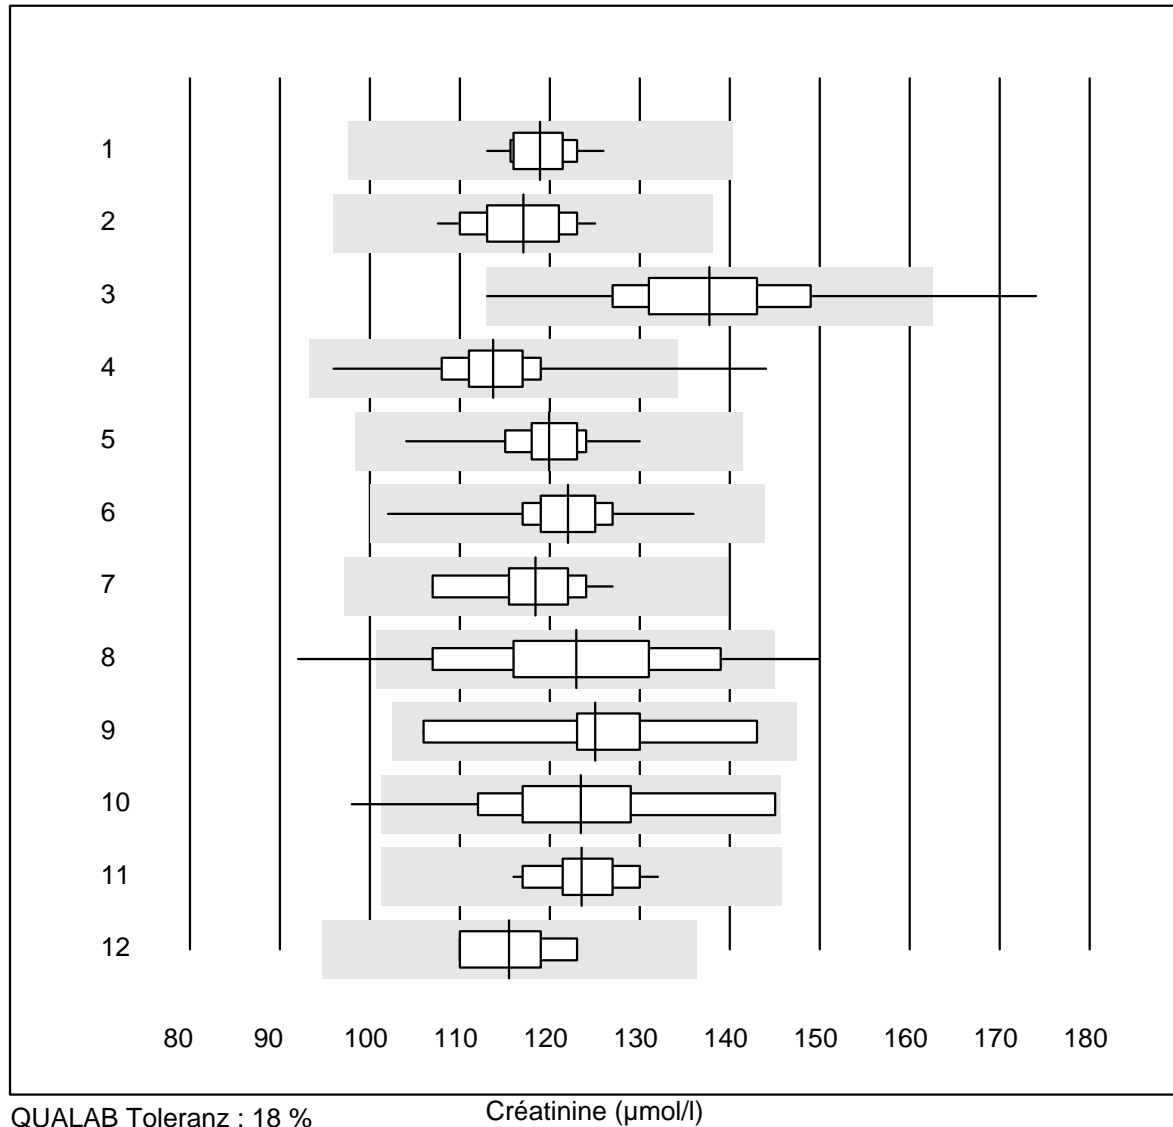

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	12	100.0	0.0	0.0	119	3.1	e
2	Cobas	22	100.0	0.0	0.0	117	4.4	e
3	Reflotron	715	96.2	2.5	1.3	138	6.9	e
4	Fuji Dri-Chem	920	98.9	0.3	0.8	114	4.4	e
5	Spotchem/Ready	89	100.0	0.0	0.0	120	3.4	e
6	Spotchem D-Concept	340	100.0	0.0	0.0	122	3.5	e
7	Enzymatisch	10	100.0	0.0	0.0	118	4.8	e
8	Piccolo	55	87.3	9.1	3.6	123	10.6	e
9	Abx Mira	9	100.0	0.0	0.0	125	7.8	e*
10	Hitachi S40/M40	14	92.9	7.1	0.0	123	10.1	e*
11	Autolyser/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	124	3.6	e
12	Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	116	5.2	e*
13	EPOC	9	88.9	0.0	11.1	130	7.2	e*

## Créatinine E

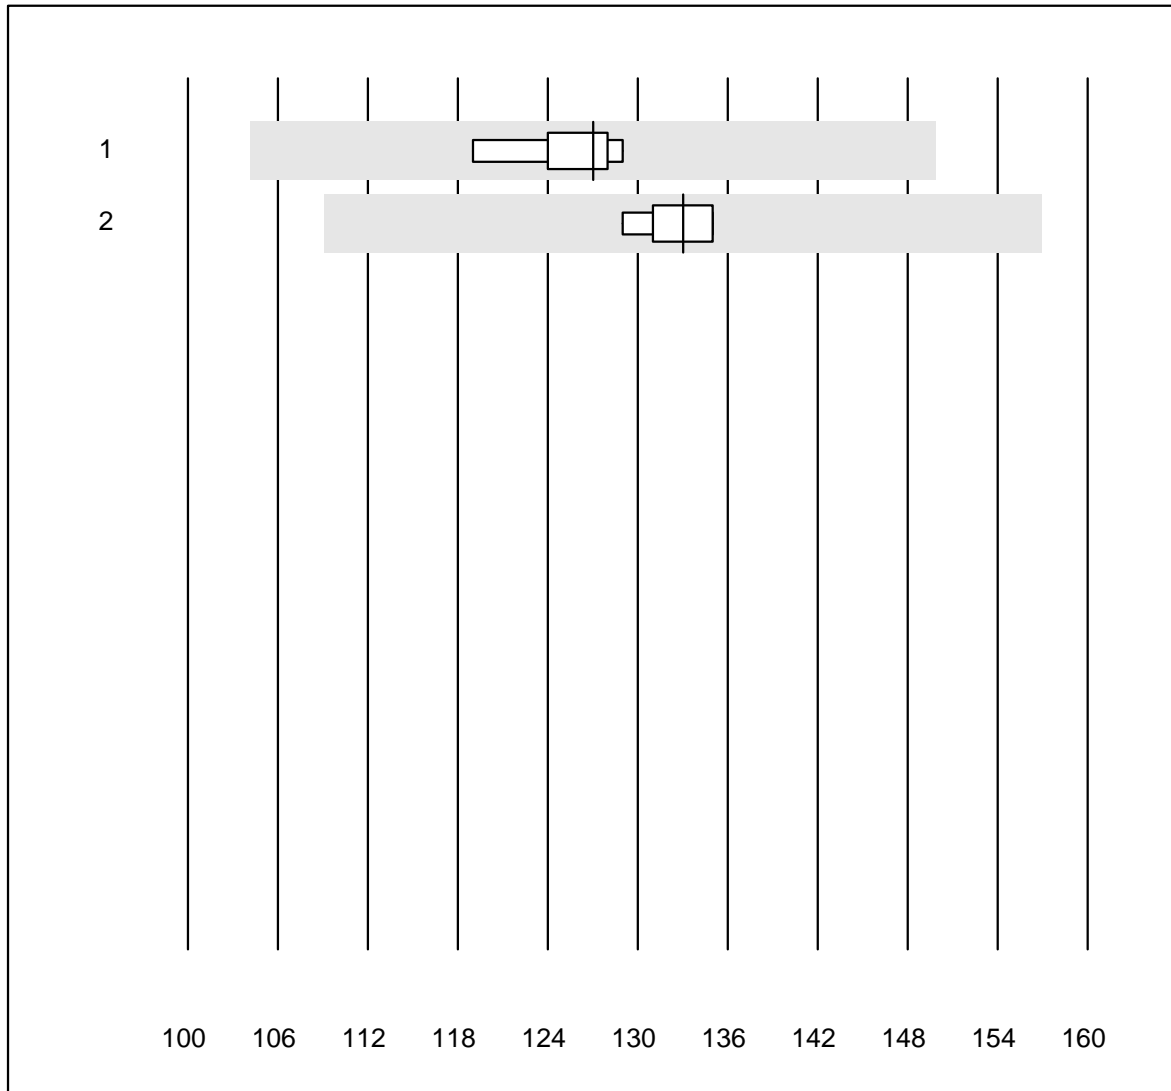


QUALAB Toleranz : 18 %

Créatinine E (µmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 iStat Chem8	9	100.0	0.0	0.0	127	2.5	e
2 ABL700/800	6	100.0	0.0	0.0	133	1.8	e

## eGFR CKD-EPI

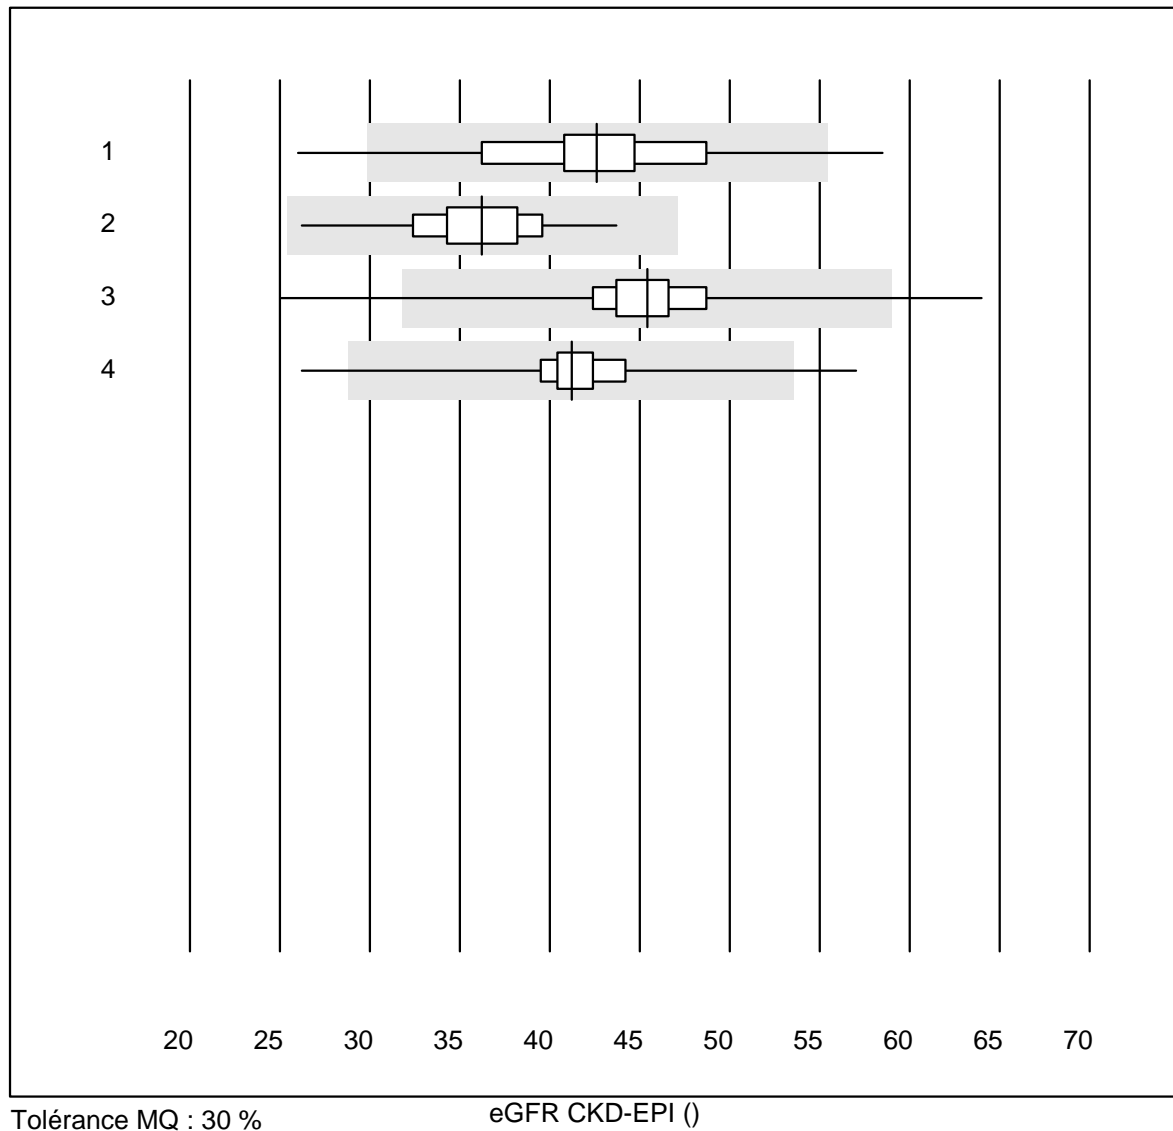


Tolérance MQ : 30 %

eGFR CKD-EPI ( )

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	70	91.4	2.9	5.7	43	12.4	e
2	Reflotron	237	97.0	0.0	3.0	36	8.5	e
3	Fuji Dri-Chem	361	95.3	1.1	3.6	45	7.5	e
4	Spotchem/Ready	165	94.0	1.2	4.8	41	7.0	e

## eGFR Cockcroft-Gault

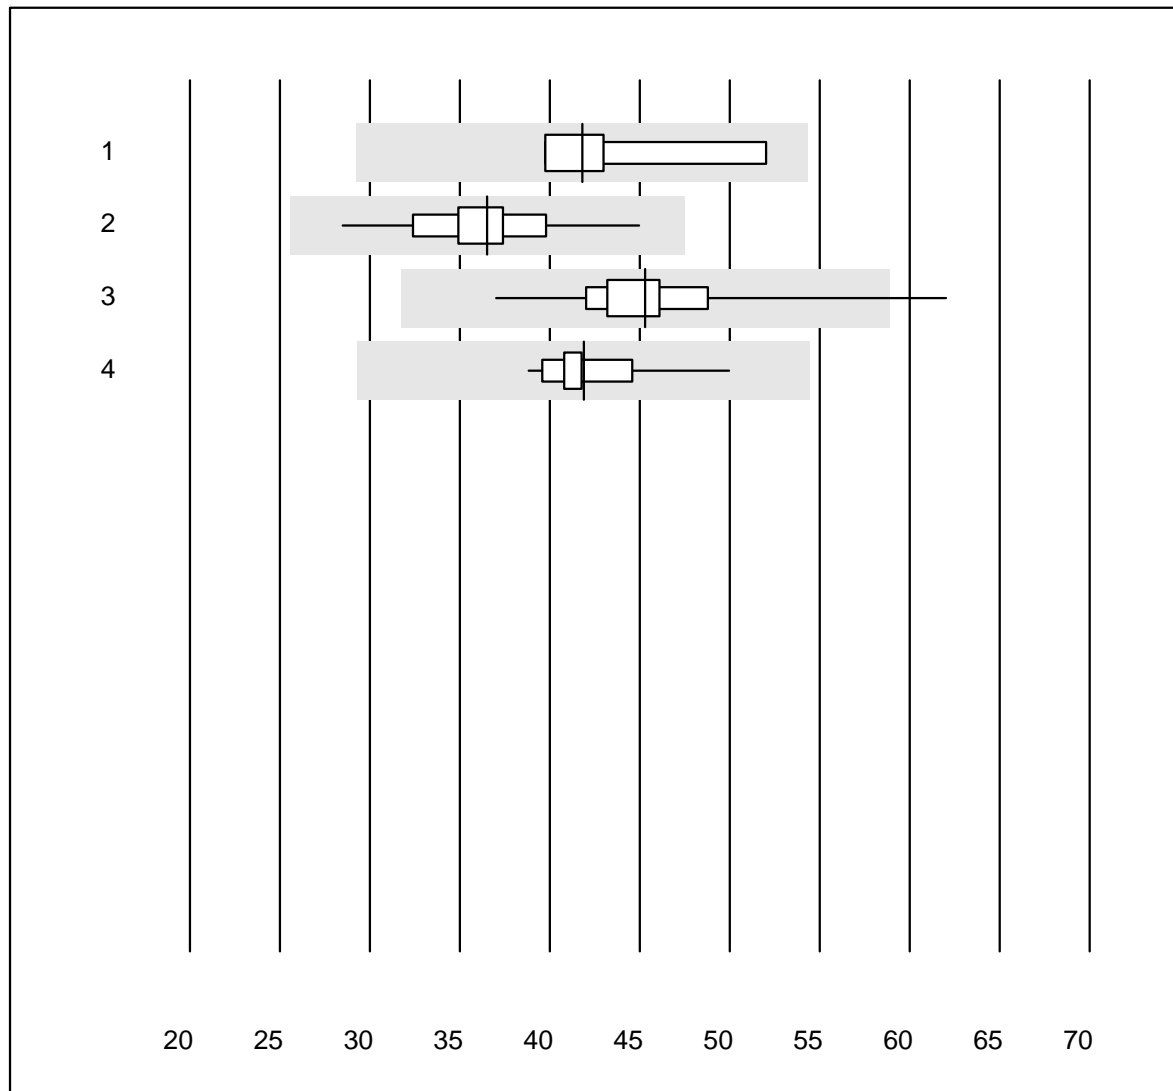


Tolérance MQ : 30 %

eGFR Cockcroft-Gault ( )


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	5	80.0	0.0	20.0	42	12.3	e*
2	Reflotron	22	90.9	0.0	9.1	37	8.8	e
3	Fuji Dri-Chem	54	88.8	1.9	9.3	45	8.2	e
4	Spotchem/Ready	21	81.0	0.0	19.0	42	6.0	e

## eGFR MDRD

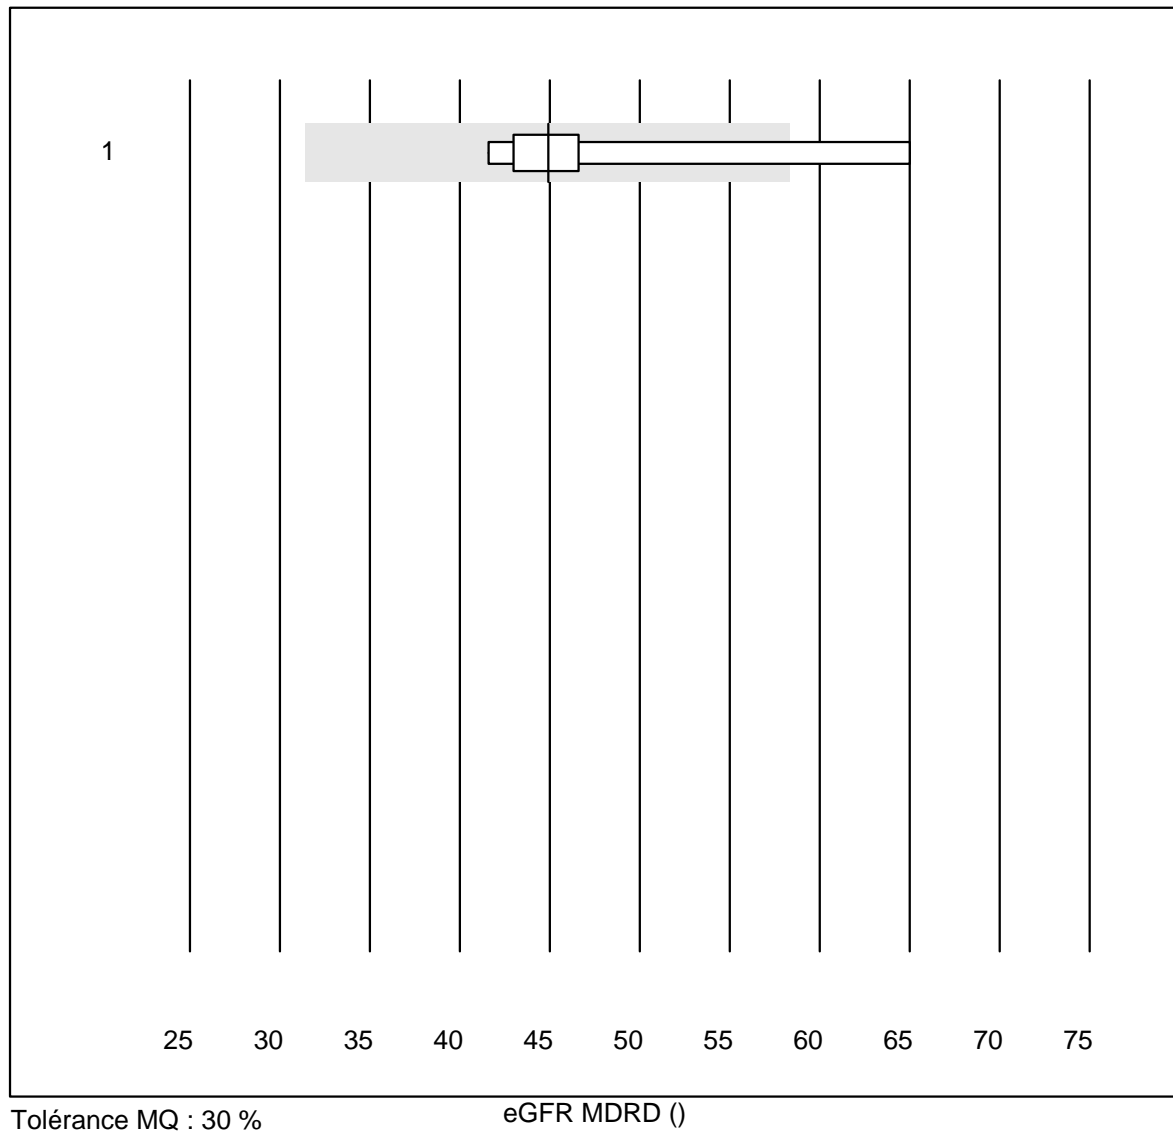

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Fuji Dri-Chem	6	83.3	16.7	0.0	45	18.2	e*


## LDH

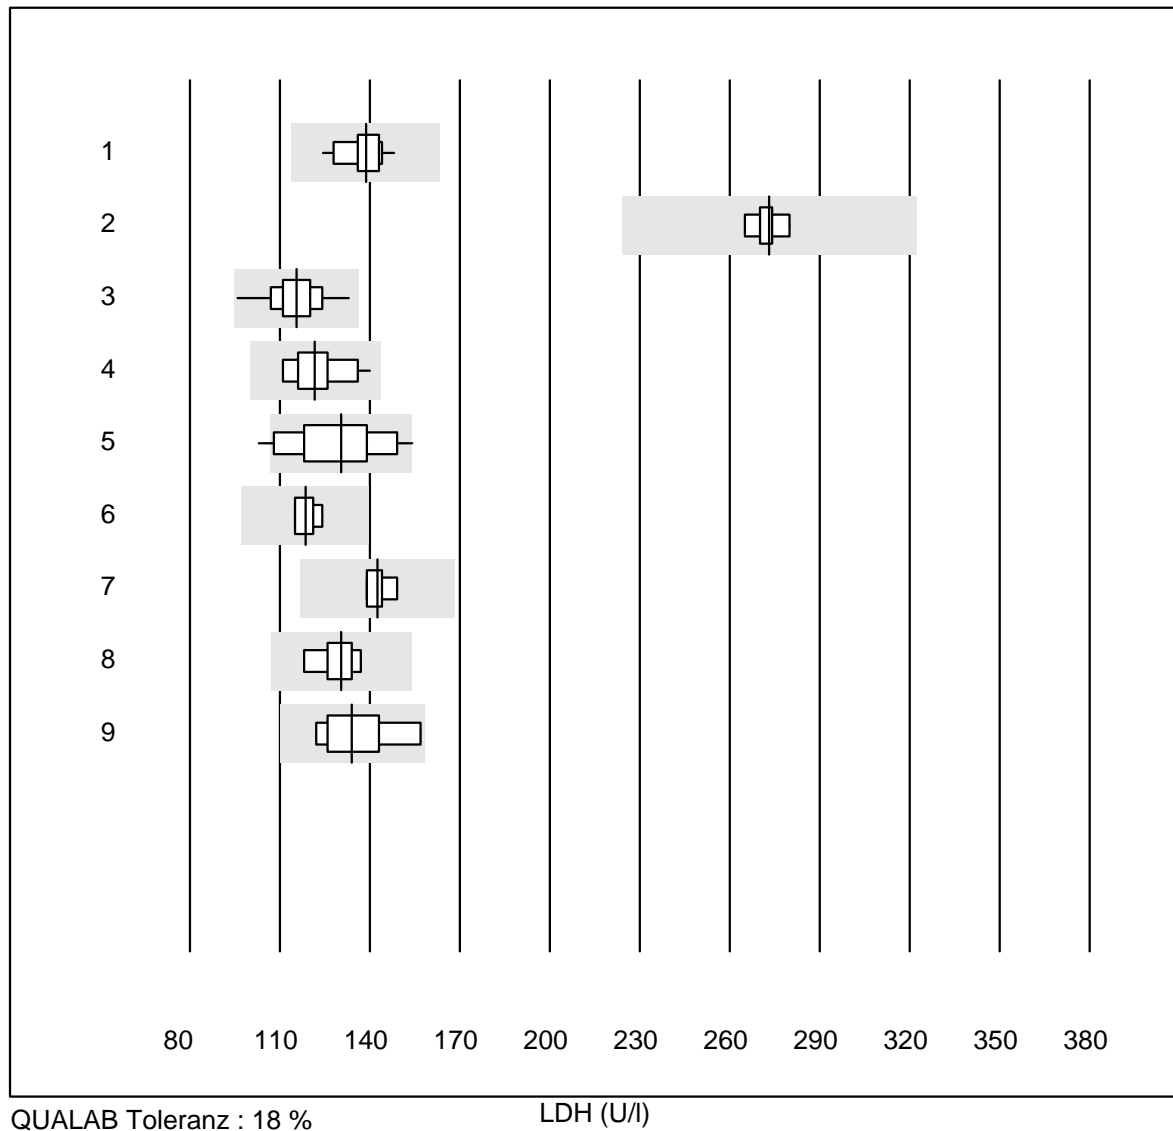

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	IFCC	36	97.2	0.0	2.8	139	4.2	e
2	Cobas	8	100.0	0.0	0.0	273	1.7	e
3	Fuji Dri-Chem	136	99.3	0.0	0.7	115	5.6	e
4	Spotchem/Ready	15	93.3	0.0	6.7	122	7.5	e
5	Spotchem D-Concept	47	85.1	8.5	6.4	130	11.0	e
6	Piccolo	6	100.0	0.0	0.0	119	3.2	e
7	Abx Mira	4	100.0	0.0	0.0	143	3.0	e
8	Hitachi S40/M40	6	100.0	0.0	0.0	131	5.2	e
9	Autolyser/DiaSys	9	100.0	0.0	0.0	134	8.6	e*



# Magnésium

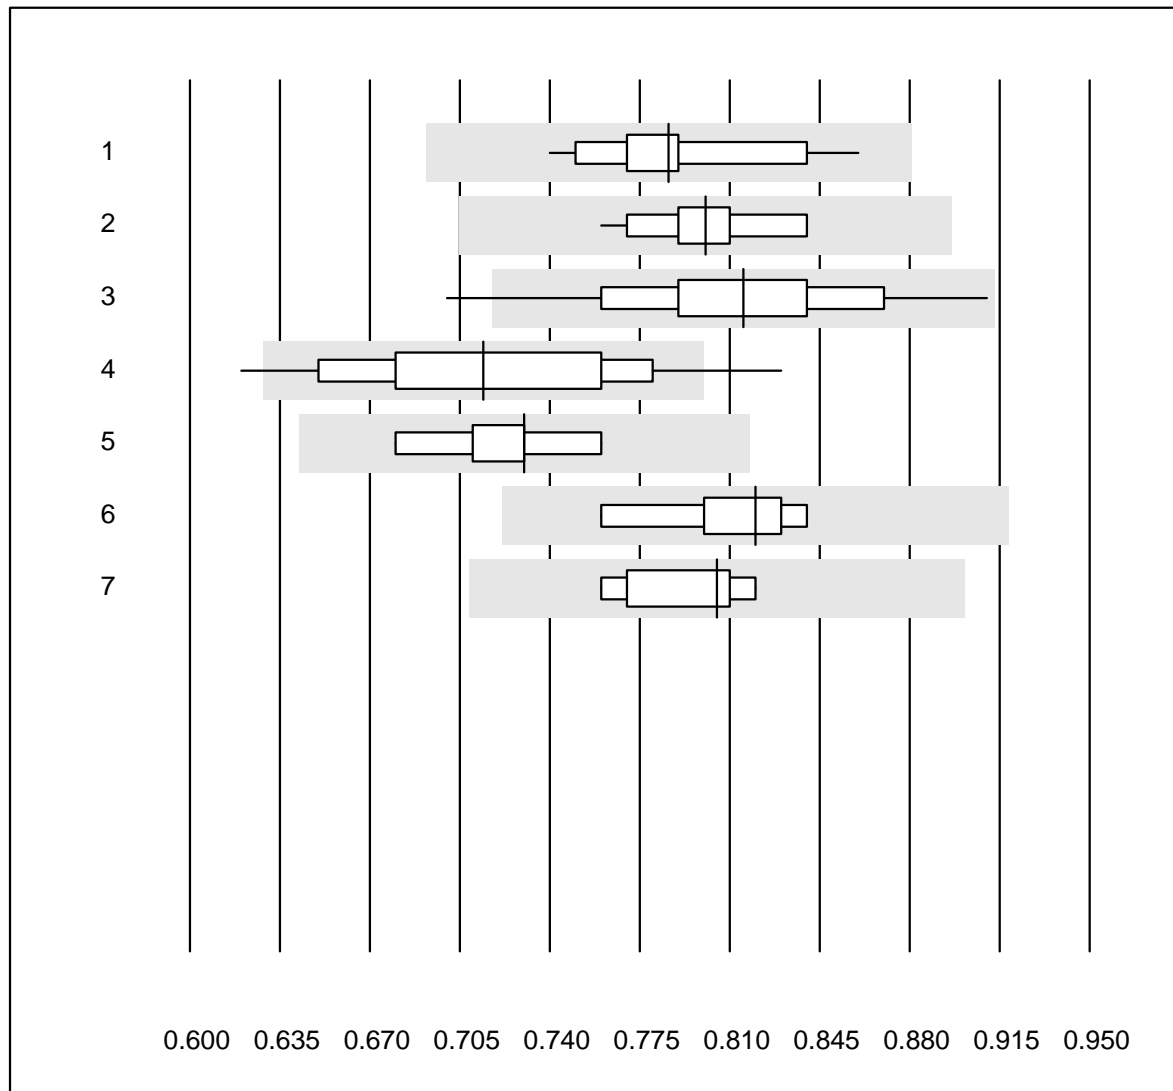


QUALAB Toleranz : 12 %

Magnésium (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	14	100.0	0.0	0.0	0.79	4.0	e
2	Cobas	17	100.0	0.0	0.0	0.80	2.7	e
3	Fuji Dri-Chem	112	98.2	1.8	0.0	0.82	4.9	e
4	Spotchem D-Concept	43	95.3	4.7	0.0	0.71	7.0	e
5	Spotchem/Ready	5	100.0	0.0	0.0	0.73	4.1	e*
6	Beckman	7	100.0	0.0	0.0	0.82	3.3	e
7	Piccolo	8	100.0	0.0	0.0	0.81	2.9	e

# Sodium

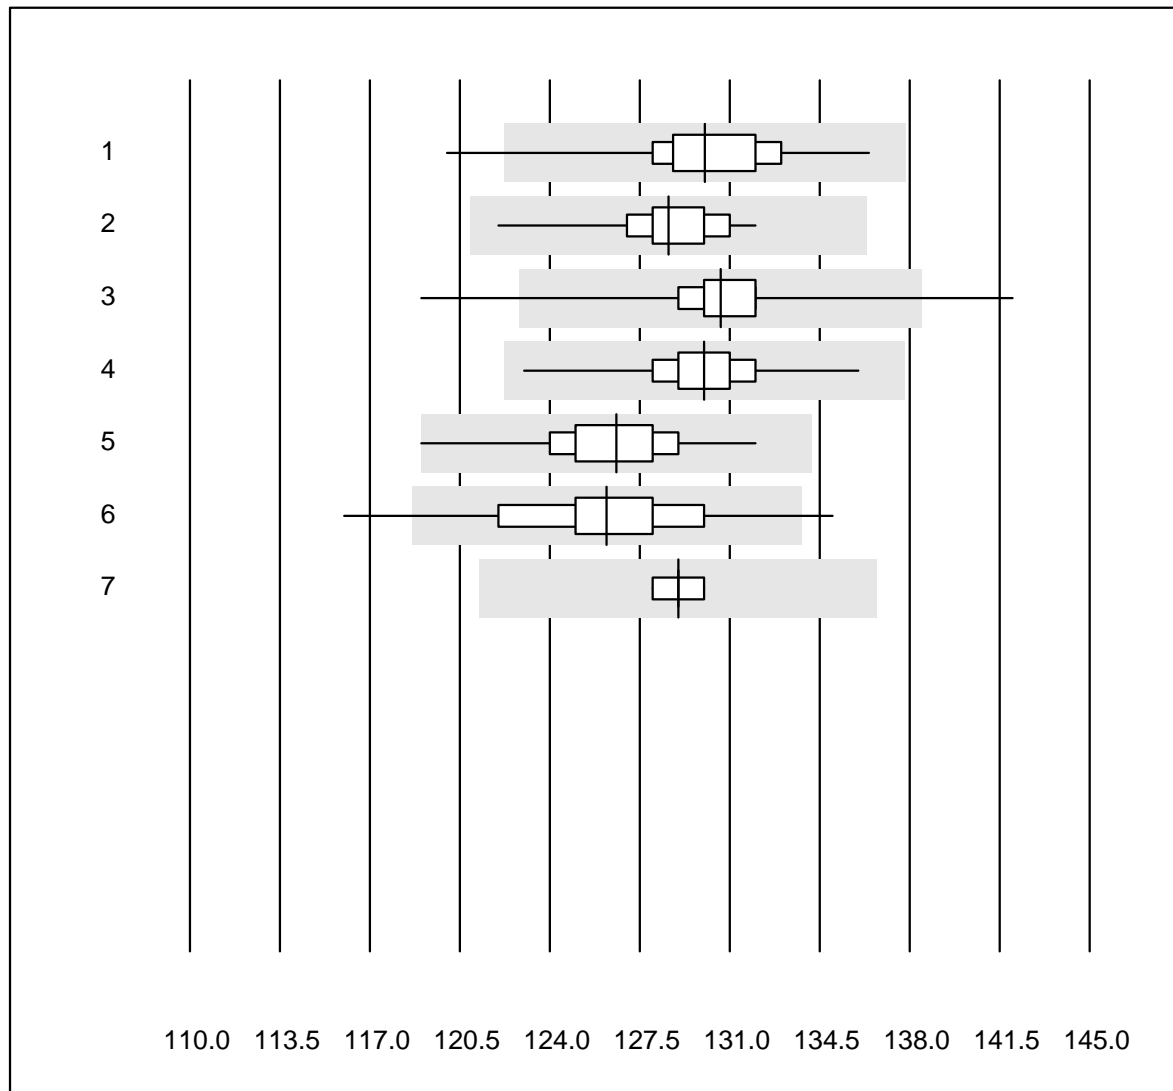


QUALAB Toleranz : 6 %

Sodium (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 ISE	40	97.5	2.5	0.0	130	2.1	e
2 Cobas	23	100.0	0.0	0.0	129	1.9	e
3 Fuji Dri-Chem	826	99.3	0.6	0.1	131	1.4	e
4 Spotchem D-Concept	306	99.7	0.0	0.3	130	1.5	e
5 Spotchem EL-SE 1520	71	98.6	0.0	1.4	127	1.9	e
6 Piccolo	37	94.6	5.4	0.0	126	2.7	e
7 iStat Chem8	5	100.0	0.0	0.0	129	0.5	e

## Phosphates

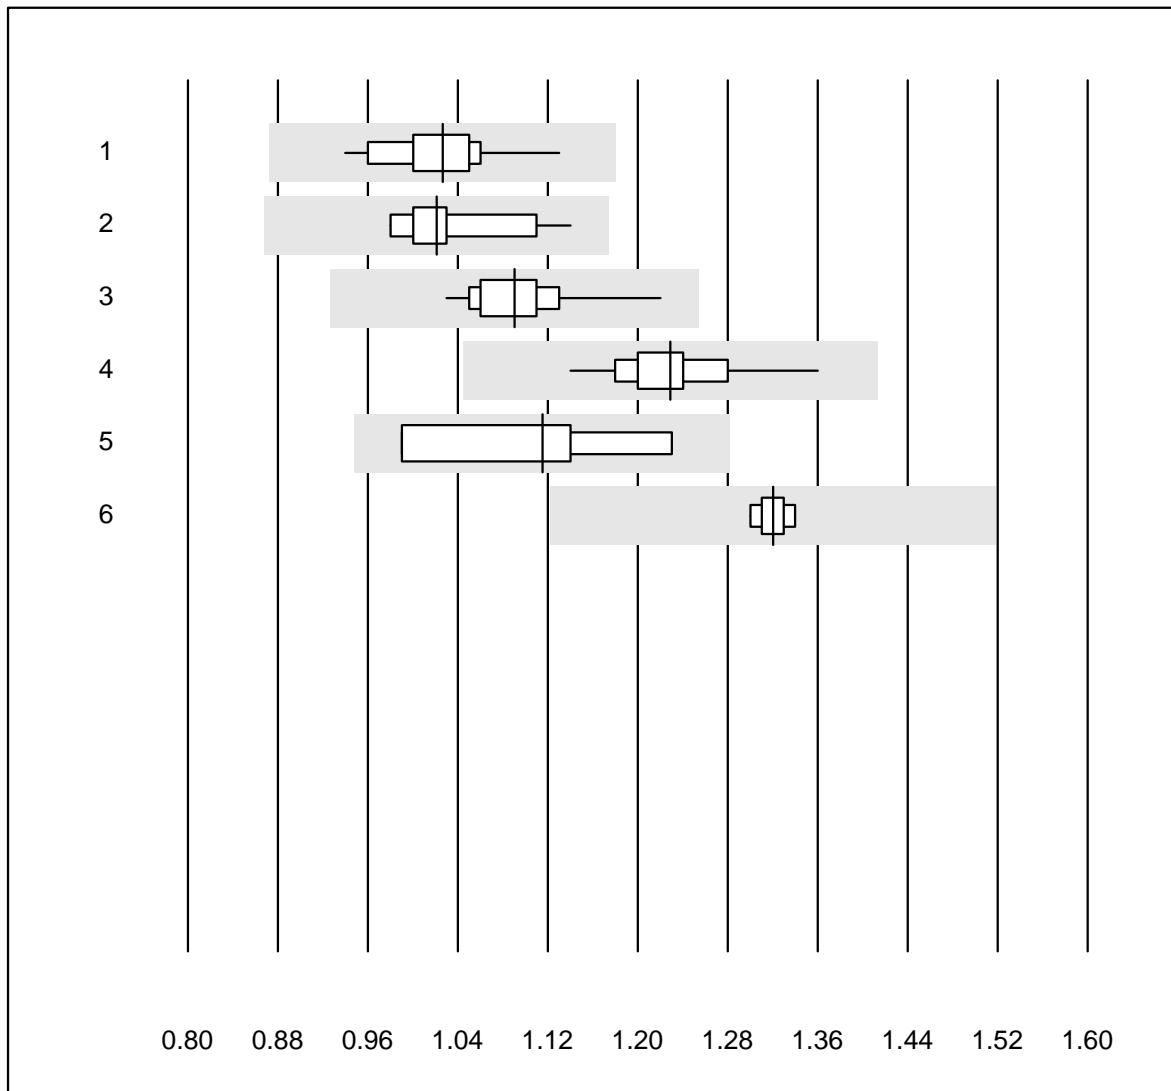


QUALAB Toleranz : 15 %

Phosphates (mmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	21	95.2	0.0	4.8	1.0	4.1	e
2	Cobas	19	100.0	0.0	0.0	1.0	4.0	e
3	Fuji Dri-Chem	84	98.8	0.0	1.2	1.1	3.2	e
4	Spotchem D-Concept	21	100.0	0.0	0.0	1.2	4.2	e
5	Spotchem/Ready	4	100.0	0.0	0.0	1.1	9.0	e*
6	Piccolo	6	100.0	0.0	0.0	1.3	1.1	e

# Protéine

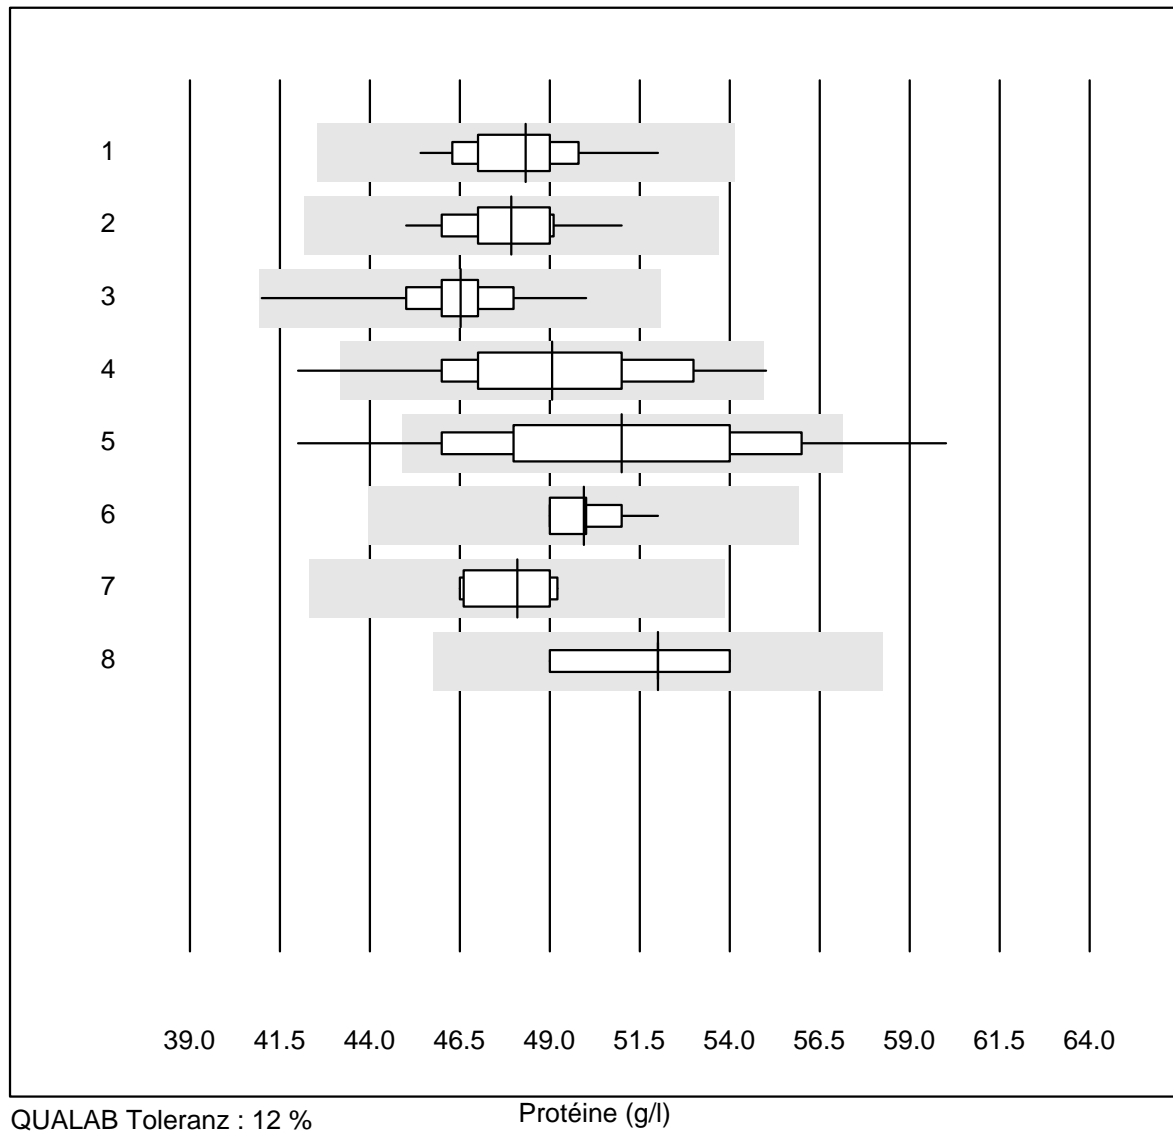

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	23	100.0	0.0	0.0	48.3	3.0	e
2	Cobas	19	100.0	0.0	0.0	47.9	2.9	e
3	Fuji Dri-Chem	185	98.4	0.0	1.6	46.5	2.7	e
4	Spotchem/Ready	27	88.9	7.4	3.7	49.1	5.8	e
5	Spotchem D-Concept	120	91.7	8.3	0.0	51.0	7.5	e
6	Piccolo	38	97.4	0.0	2.6	49.9	1.7	e
7	Abx Mira	5	100.0	0.0	0.0	48.1	2.7	e
8	Hitachi S40/M40	5	100.0	0.0	0.0	52.0	3.5	e*

## Transaminase GOT/AST

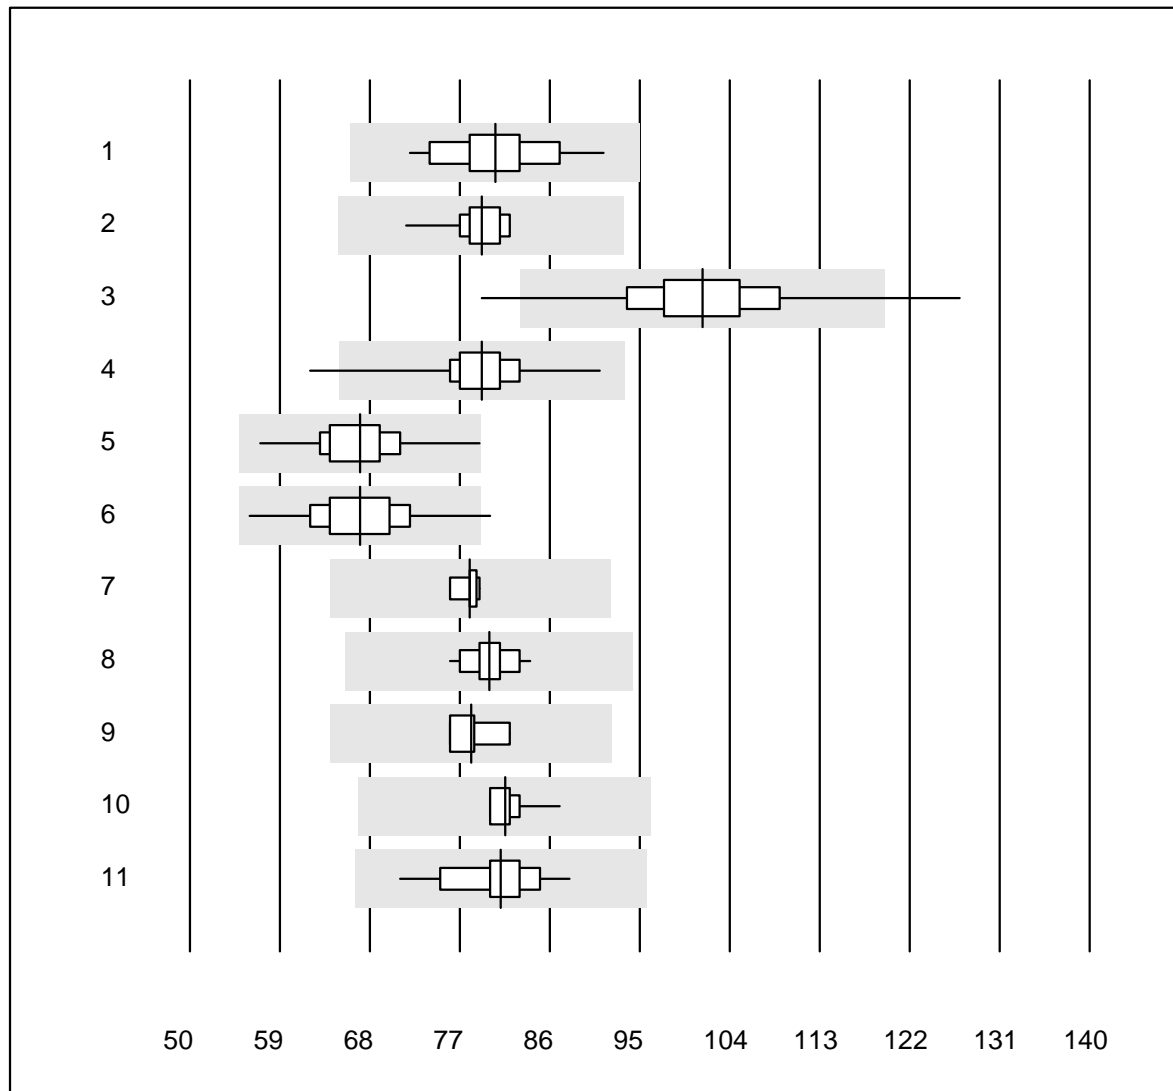


QUALAB Toleranz : 18 %

Transaminase GOT/AST (U/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	IFCC avec PP	27	100.0	0.0	0.0	81	5.7	e
2	Cobas	19	100.0	0.0	0.0	79	3.2	e
3	Reflotron	616	96.6	1.6	1.8	101	6.4	e
4	Fuji Dri-Chem	897	99.7	0.1	0.2	79	3.5	e
5	Spotchem/Ready	84	98.8	0.0	1.2	67	5.7	e
6	Spotchem D-Concept	343	99.7	0.3	0.0	67	6.3	e
7	IFCC sens PP	5	100.0	0.0	0.0	78	1.5	e
8	Piccolo	58	100.0	0.0	0.0	80	2.4	e
9	Abx Mira	8	100.0	0.0	0.0	78	2.5	e
10	Hitachi S40/M40	14	100.0	0.0	0.0	82	2.3	e
11	Autolyser/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	81	4.7	e

## Transaminase GPT/ALT

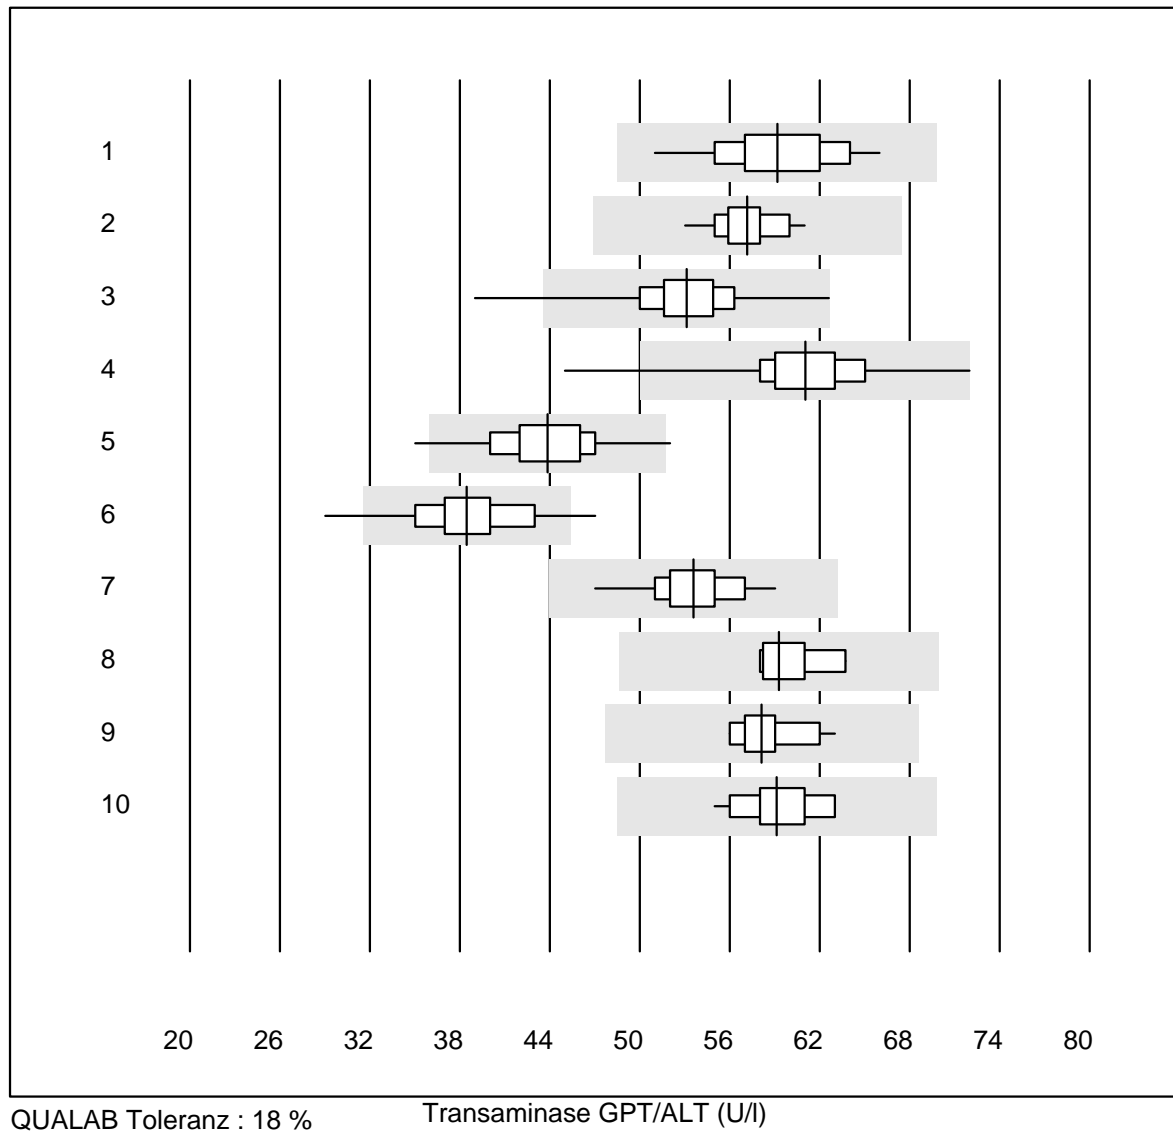

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC avec PP	25	100.0	0.0	0.0	59	6.2	e
2 Cobas	24	100.0	0.0	0.0	57	3.8	e
3 Reflotron	637	97.0	1.9	1.1	53	5.8	e
4 Fuji Dri-Chem	911	98.7	0.5	0.8	61	5.3	e
5 Spotchem/Ready	87	96.6	2.3	1.1	44	6.7	e
6 Spotchem D-Concept	345	97.7	2.0	0.3	38	7.7	e
7 Piccolo	57	100.0	0.0	0.0	54	4.7	e
8 Abx Mira	7	100.0	0.0	0.0	59	3.3	e
9 Hitachi S40/M40	15	100.0	0.0	0.0	58	3.7	e
10 Autolyser/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	59	3.7	e

## Triglycérides

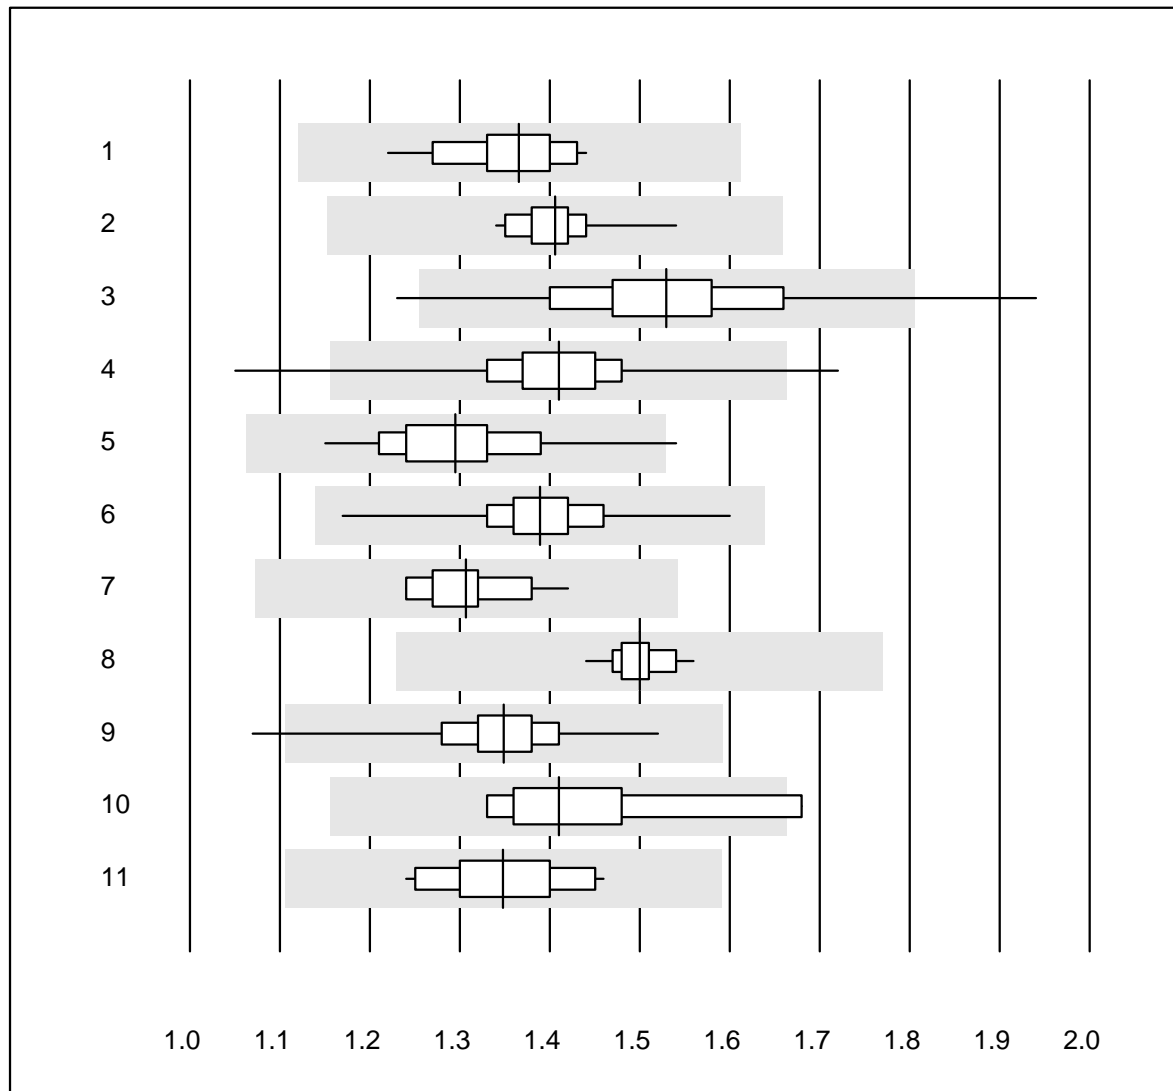


QUALAB Toleranz : 18 %

Triglycérides (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	28	96.4	0.0	3.6	1.37	4.6	e
2	Cobas	23	100.0	0.0	0.0	1.41	3.3	e
3	Reflotron	317	93.1	1.9	5.0	1.53	6.9	e
4	Fuji Dri-Chem	792	98.1	0.8	1.1	1.41	4.6	e
5	Spotchem/Ready	72	97.2	1.4	1.4	1.30	5.8	e
6	Spotchem D-Concept	299	97.7	0.0	2.3	1.39	3.8	e
7	Hitachi S40/M40	10	100.0	0.0	0.0	1.31	4.3	e
8	Piccolo	20	95.0	0.0	5.0	1.50	1.9	e
9	Cholestech LDX	311	99.1	0.3	0.6	1.35	3.9	e
10	Abx Mira	7	85.7	14.3	0.0	1.41	8.1	e*
11	Autolyser/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	1.35	5.2	e

## Lithium

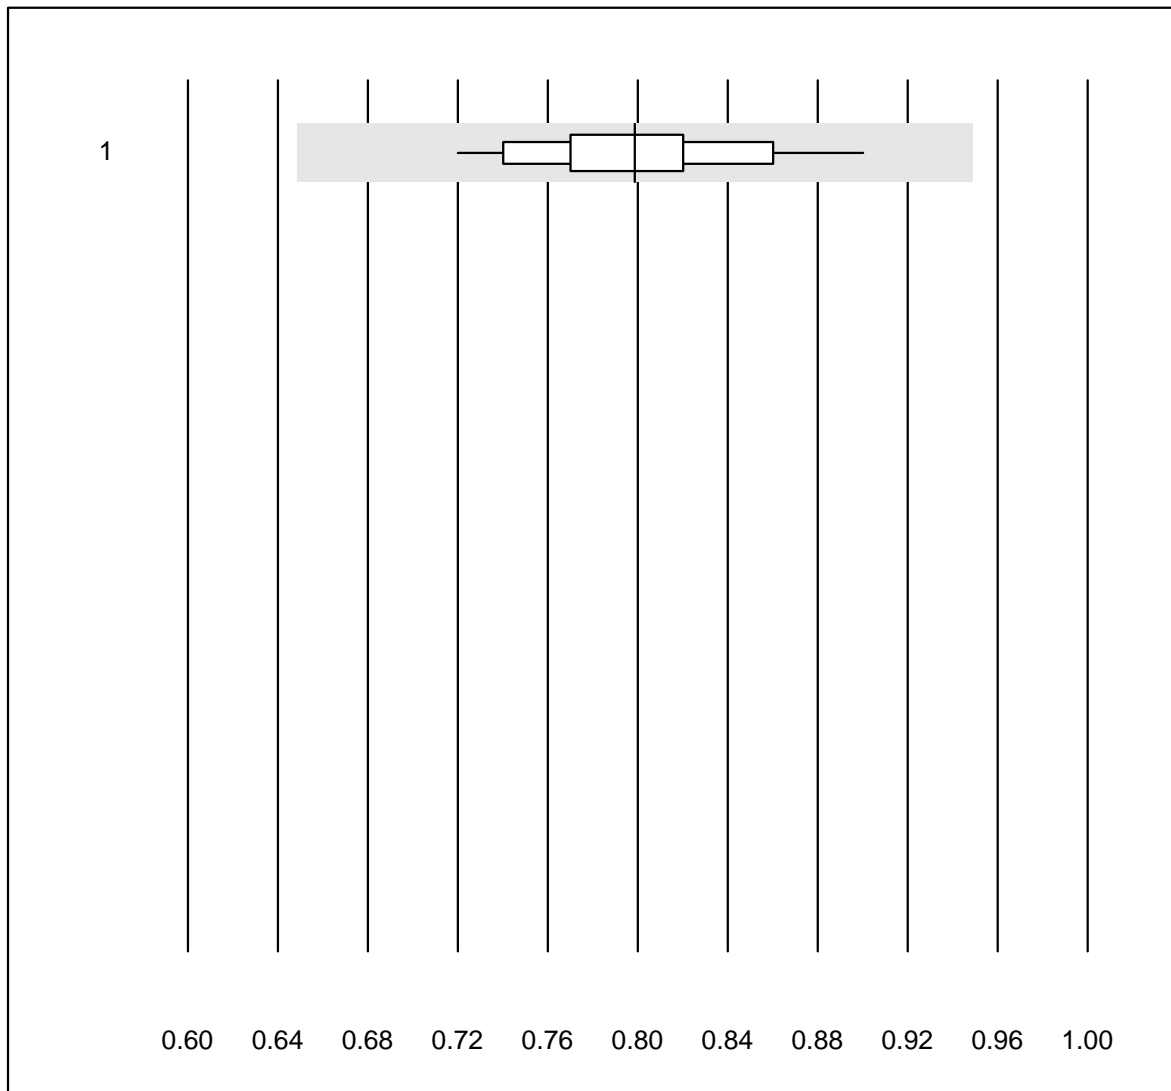


QUALAB Toleranz : 15 %  
 (< 1.00: +/- 0.15 mmol/l)

Lithium (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	17	100.0	0.0	0.0	0.80	5.6	e




# Laktat

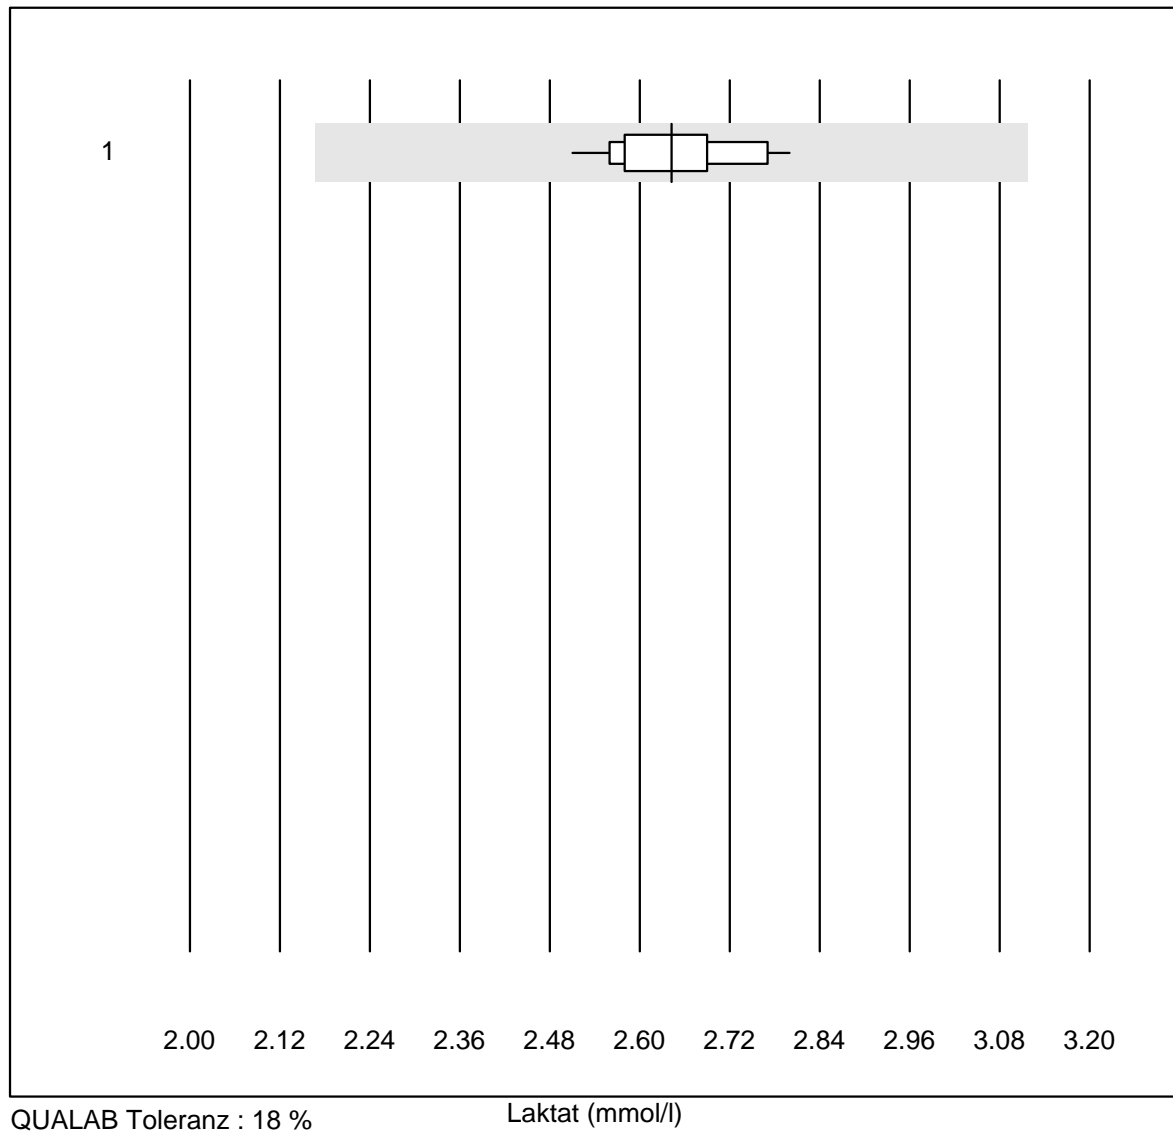

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	12	100.0	0.0	0.0	2.64	3.2	e

## HbA1c échantillon A

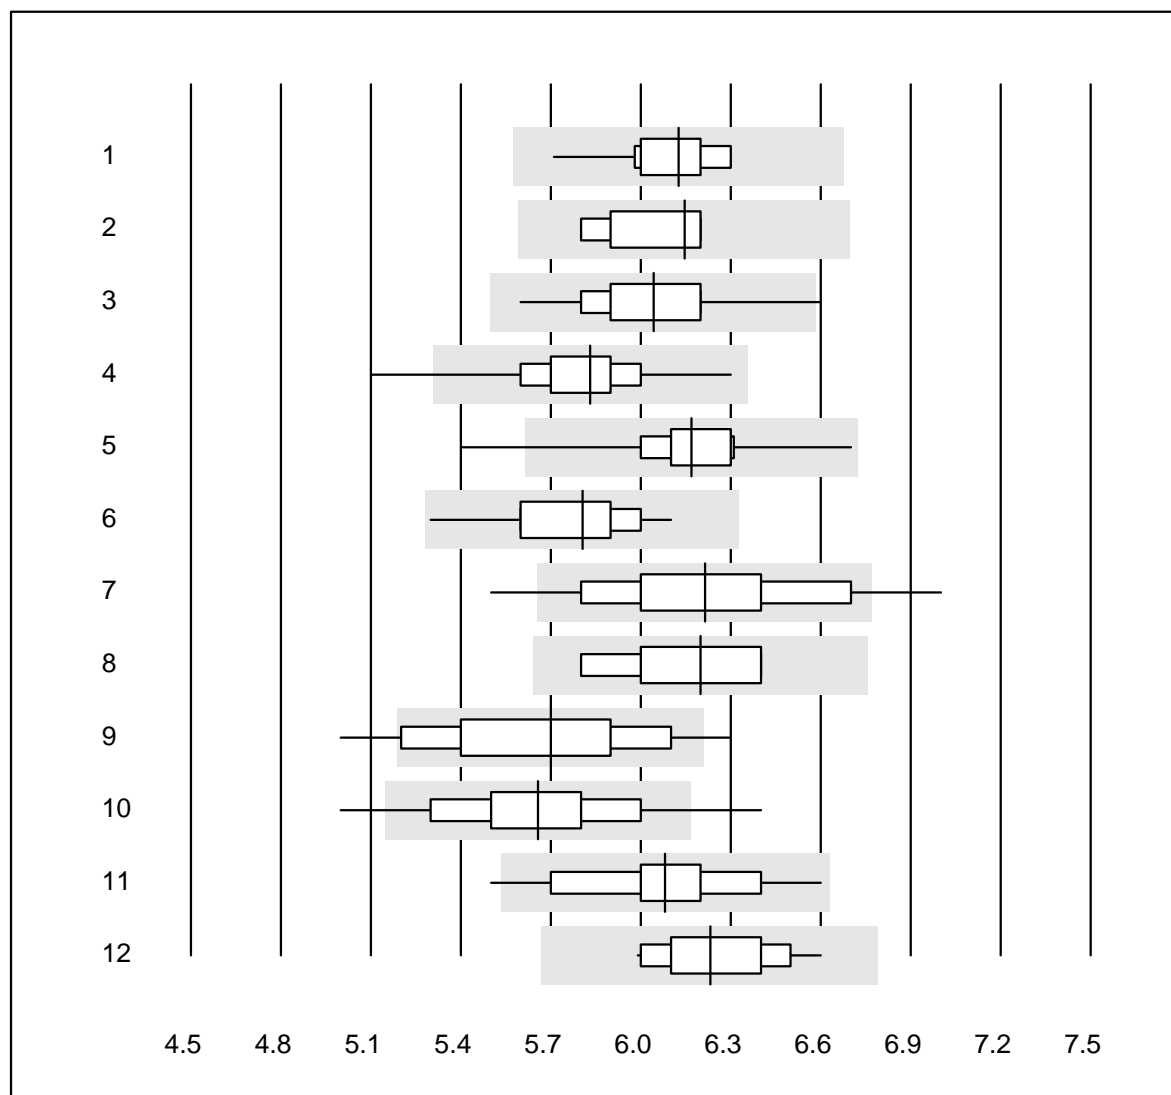


QUALAB Toleranz : 9 %

HbA1c échantillon A (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Roche, Cobas	16	100.0	0.0	0.0	6.1	2.5	e
2	HPLC	8	100.0	0.0	0.0	6.1	2.6	e
3	Afinion	533	99.0	0.8	0.2	6.0	2.8	e
4	Cobas b101	132	96.9	2.3	0.8	5.8	3.1	e
5	DCA2000/Vantage	156	98.1	1.3	0.6	6.2	2.8	e
6	Celltac chemi	20	100.0	0.0	0.0	5.8	3.3	e
7	NycoCard	35	80.0	5.7	14.3	6.2	5.3	e
8	Eurolyser	8	87.5	0.0	12.5	6.2	3.7	e*
9	A1c Now	213	85.4	8.5	6.1	5.7	5.9	e
10	AFIAS	60	93.3	5.0	1.7	5.7	4.8	e
11	Andere	15	93.3	6.7	0.0	6.1	4.3	e*
12	Spinit	11	100.0	0.0	0.0	6.2	3.2	e


## HbA1c échantillon B

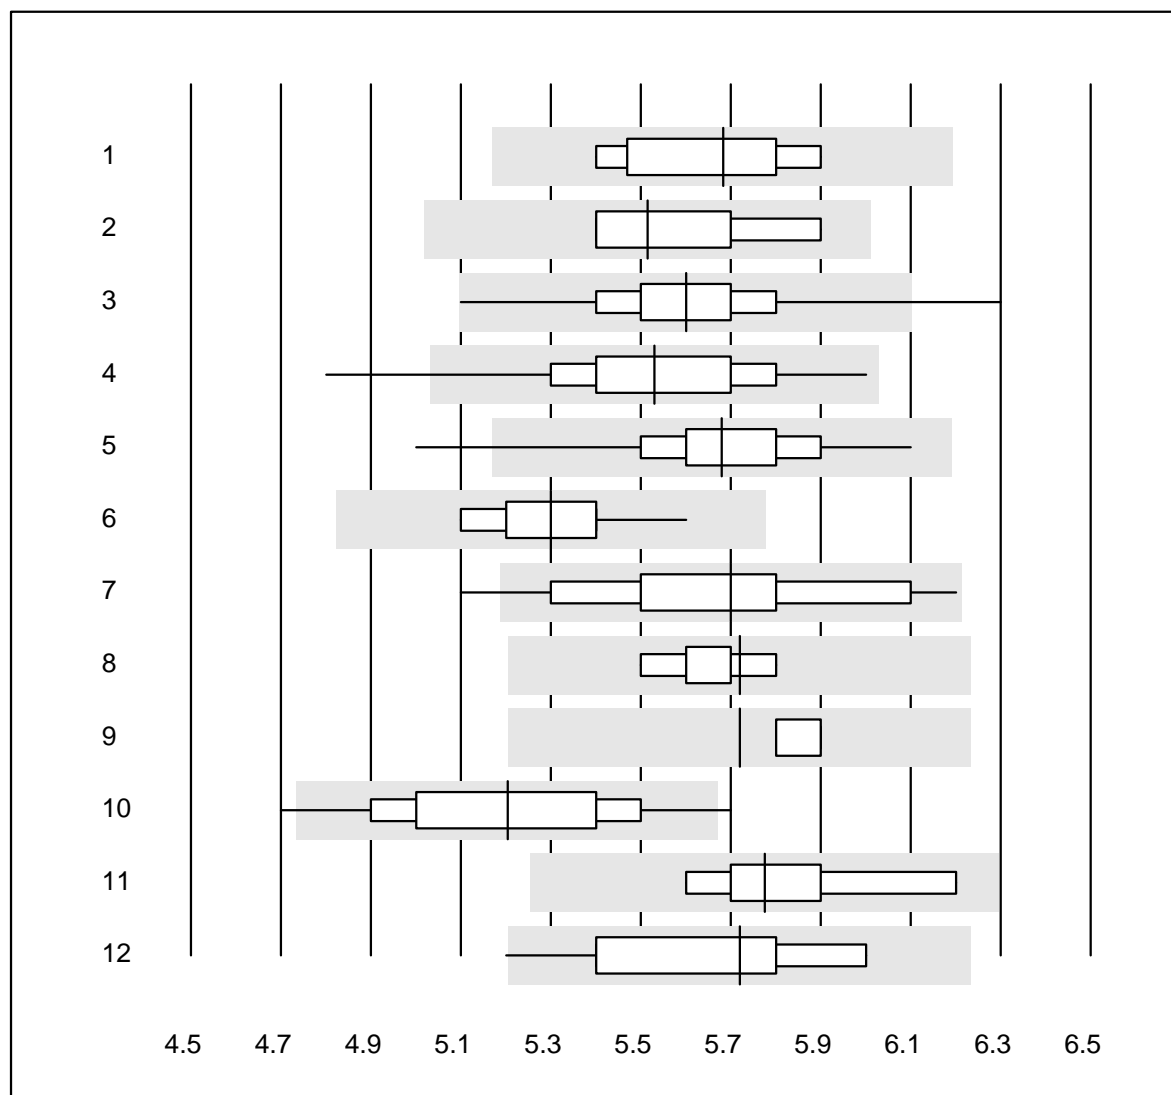

QUALAB Toleranz : 9 %


HbA1c échantillon B (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Roche, Cobas	15	100.0	0.0	0.0	5.7	3.3	e
2	HPLC	8	100.0	0.0	0.0	5.5	3.4	e*
3	Afinion	747	99.8	0.1	0.1	5.6	2.6	e
4	Cobas b101	124	96.8	3.2	0.0	5.5	3.7	e
5	DCA2000/Vantage	212	99.0	0.5	0.5	5.7	2.9	e
6	Celltac chemi	13	100.0	0.0	0.0	5.3	2.7	e
7	NycoCard	14	85.8	7.1	7.1	5.7	5.7	e*
8	Eurolyser	6	100.0	0.0	0.0	5.7	1.9	a
9	A1c Now	4	75.0	0.0	25.0	5.7	1.0	a
10	AFIAS	81	92.6	6.2	1.2	5.2	4.7	e
11	Spinit	8	100.0	0.0	0.0	5.8	3.2	e*
12	Andere	13	92.3	7.7	0.0	5.7	4.3	a

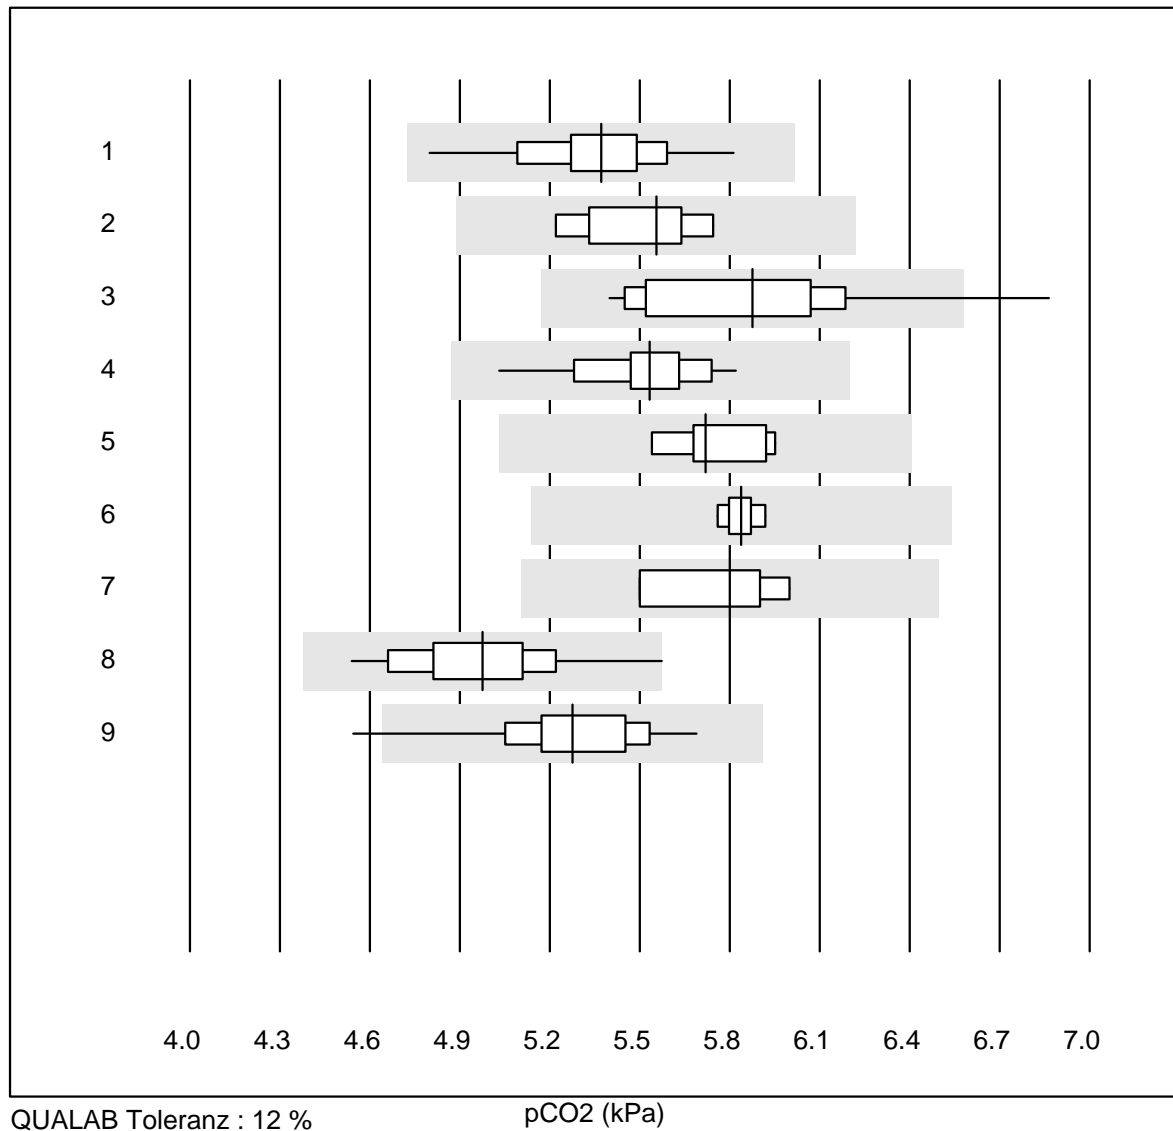pCO<sub>2</sub>


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL700/800	83	98.8	0.0	1.2	5.37	3.6	e
2	ABL80 FLEX	8	100.0	0.0	0.0	5.56	3.5	e
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	16	93.7	6.3	0.0	5.87	6.4	e*
4	ABL90 FLEX / PLUS	73	97.3	0.0	2.7	5.53	3.0	e
5	Cobas b 123	7	100.0	0.0	0.0	5.72	2.5	e
6	Cobas b 221	5	100.0	0.0	0.0	5.84	1.1	e
7	GEM	5	100.0	0.0	0.0	5.80	4.0	e*
8	iStat	47	100.0	0.0	0.0	4.98	4.4	e
9	EPOC	43	97.7	2.3	0.0	5.28	4.1	e

## pO2

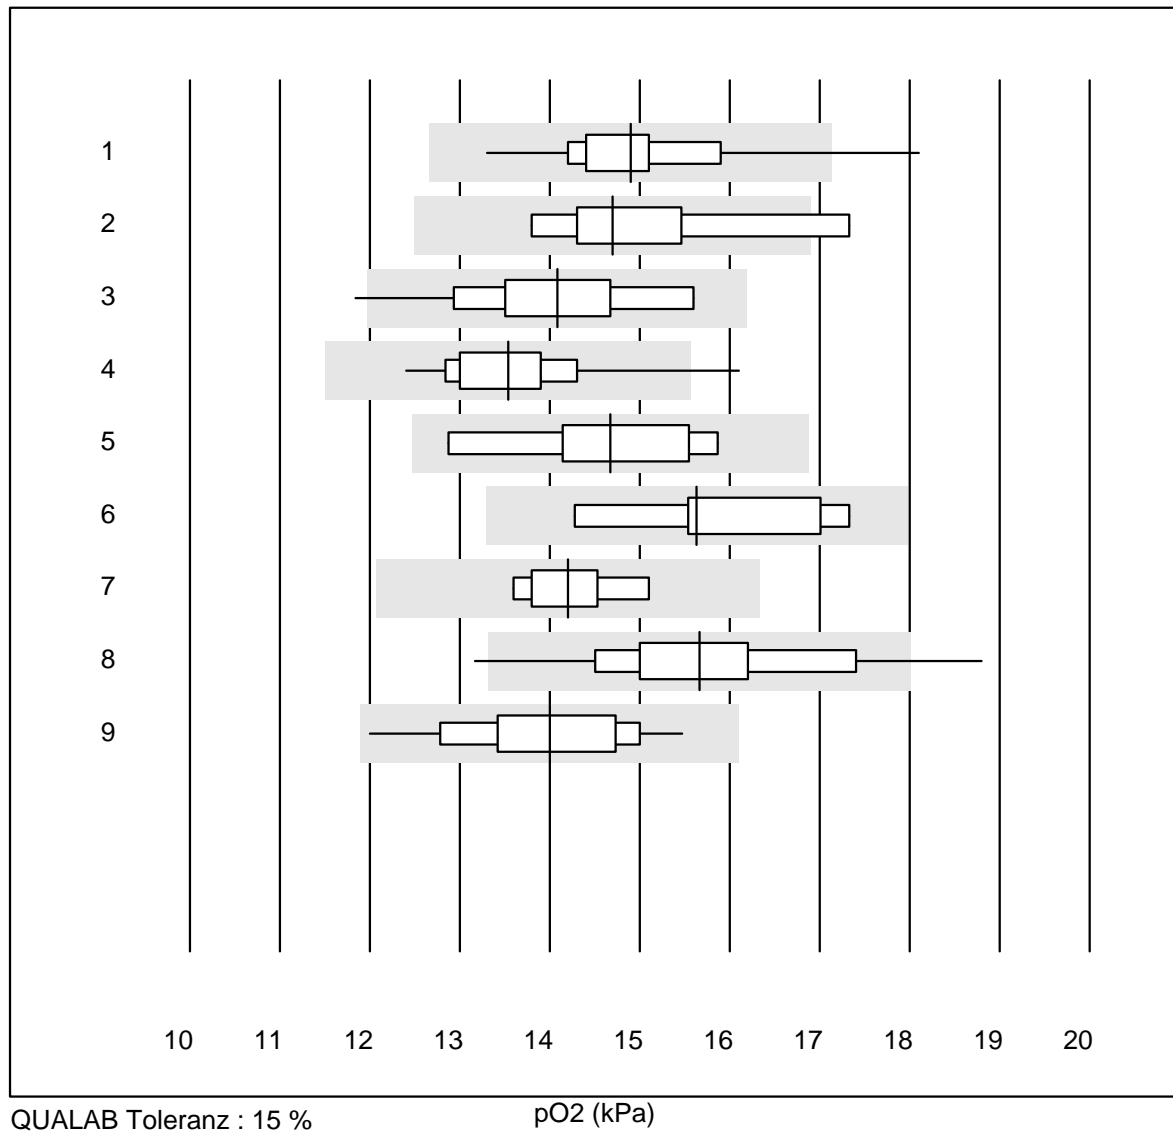

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL700/800	81	96.3	1.2	2.5	14.90	4.9	e
2	ABL80 FLEX	8	87.5	12.5	0.0	14.70	7.9	e*
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	15	86.6	6.7	6.7	14.08	7.4	e*
4	ABL90 FLEX / PLUS	74	94.5	4.1	1.4	13.54	5.6	e
5	Cobas b 123	7	100.0	0.0	0.0	14.67	7.1	e*
6	Cobas b 221	5	100.0	0.0	0.0	15.63	7.7	e*
7	GEM	5	100.0	0.0	0.0	14.20	4.2	e*
8	iStat	45	88.9	11.1	0.0	15.67	7.7	e
9	EPOC	43	93.0	0.0	7.0	14.00	6.4	e

# pH

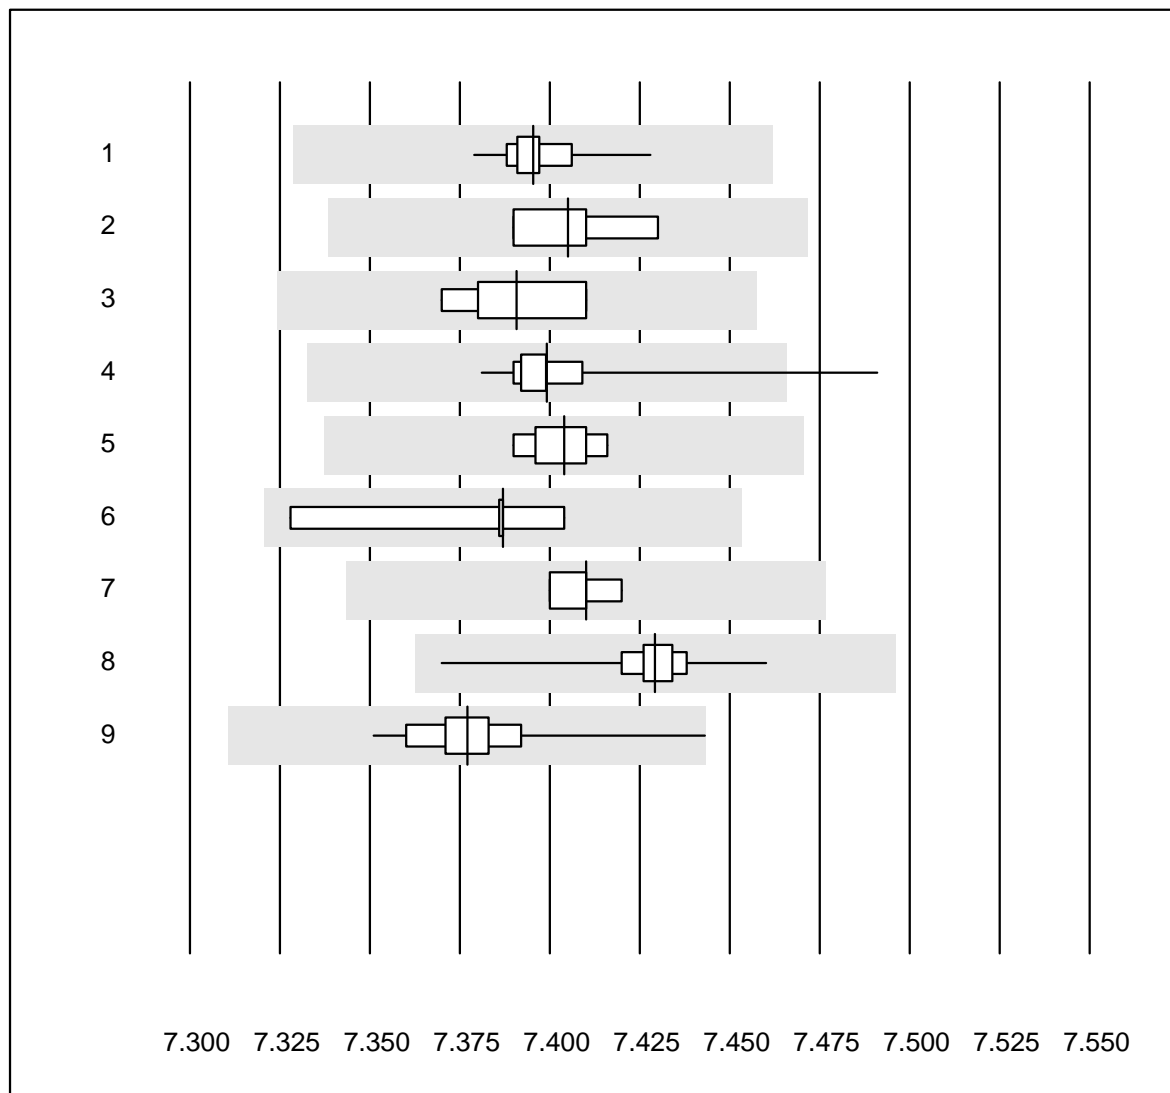


QUALAB Toleranz : 1 %

pH ()


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL700/800	82	100.0	0.0	0.0	7.40	0.1	e
2	ABL80 FLEX	8	87.5	0.0	12.5	7.41	0.2	e
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	15	100.0	0.0	0.0	7.39	0.2	e
4	ABL90 FLEX / PLUS	74	97.3	2.7	0.0	7.40	0.2	e
5	Cobas b 123	7	100.0	0.0	0.0	7.40	0.1	e
6	Cobas b 221	5	100.0	0.0	0.0	7.39	0.4	e*
7	GEM	5	100.0	0.0	0.0	7.41	0.1	e
8	iStat	47	100.0	0.0	0.0	7.43	0.2	e
9	EPOC	42	100.0	0.0	0.0	7.38	0.2	e

## Glucose GS

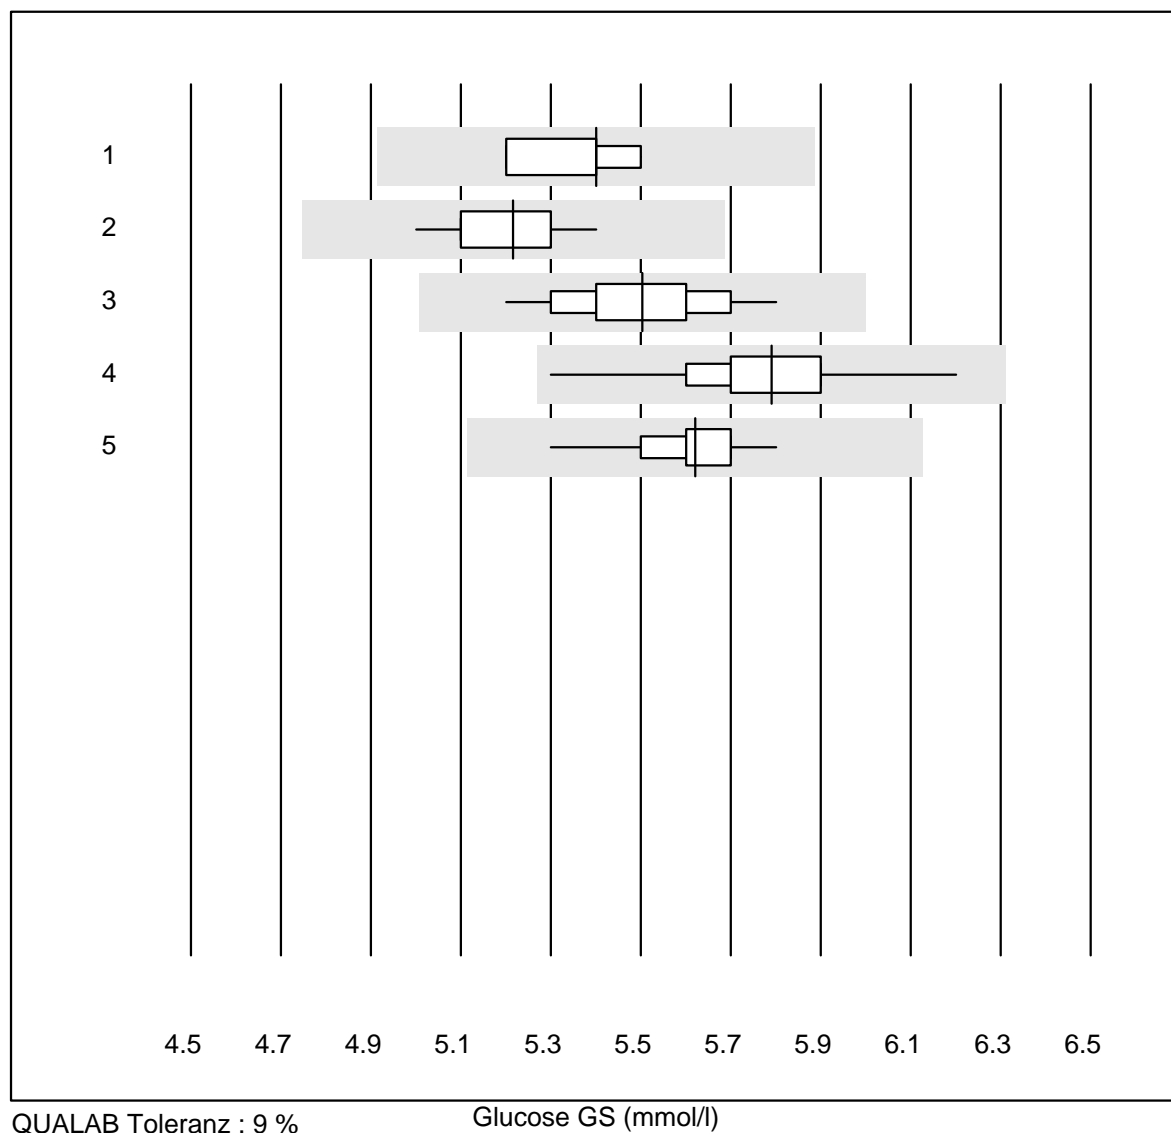

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas b 123	4	100.0	0.0	0.0	5.4	2.3	e*
2 iStat	13	92.3	0.0	7.7	5.2	2.1	e
3 EPOC	30	96.7	0.0	3.3	5.5	2.6	e
4 ABL700/800	72	100.0	0.0	0.0	5.8	2.2	e
5 ABL90 FLEX / PLUS	72	100.0	0.0	0.0	5.6	1.7	e

## Hémoglobine BG

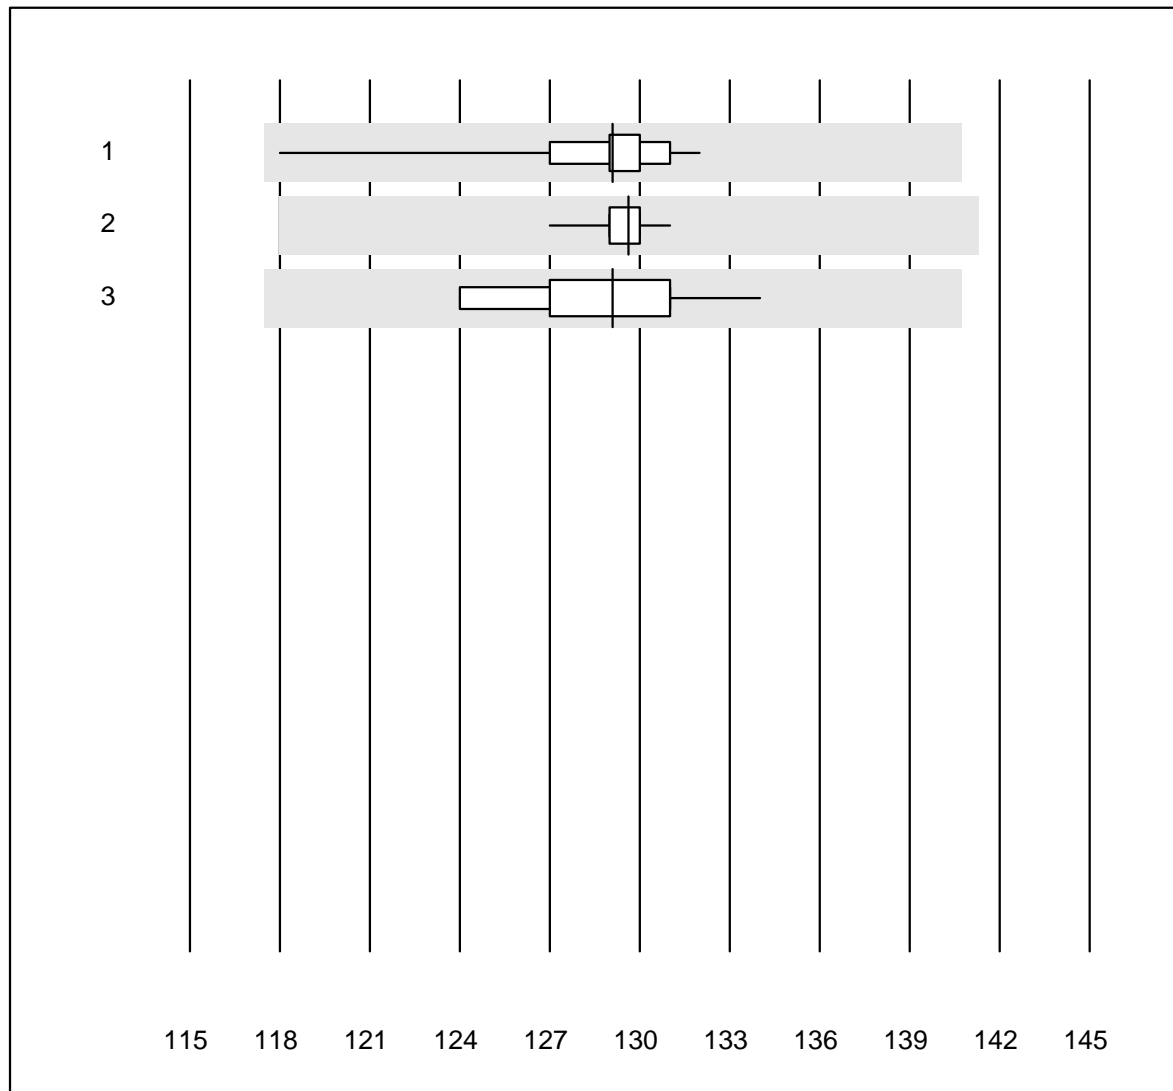


QUALAB Toleranz : 9 %

Hémoglobine BG (g/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL700/800	75	96.0	0.0	4.0	129.1	2.1	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	71	100.0	0.0	0.0	129.6	0.5	e
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	10	100.0	0.0	0.0	129.1	2.3	e




## Potassium BG

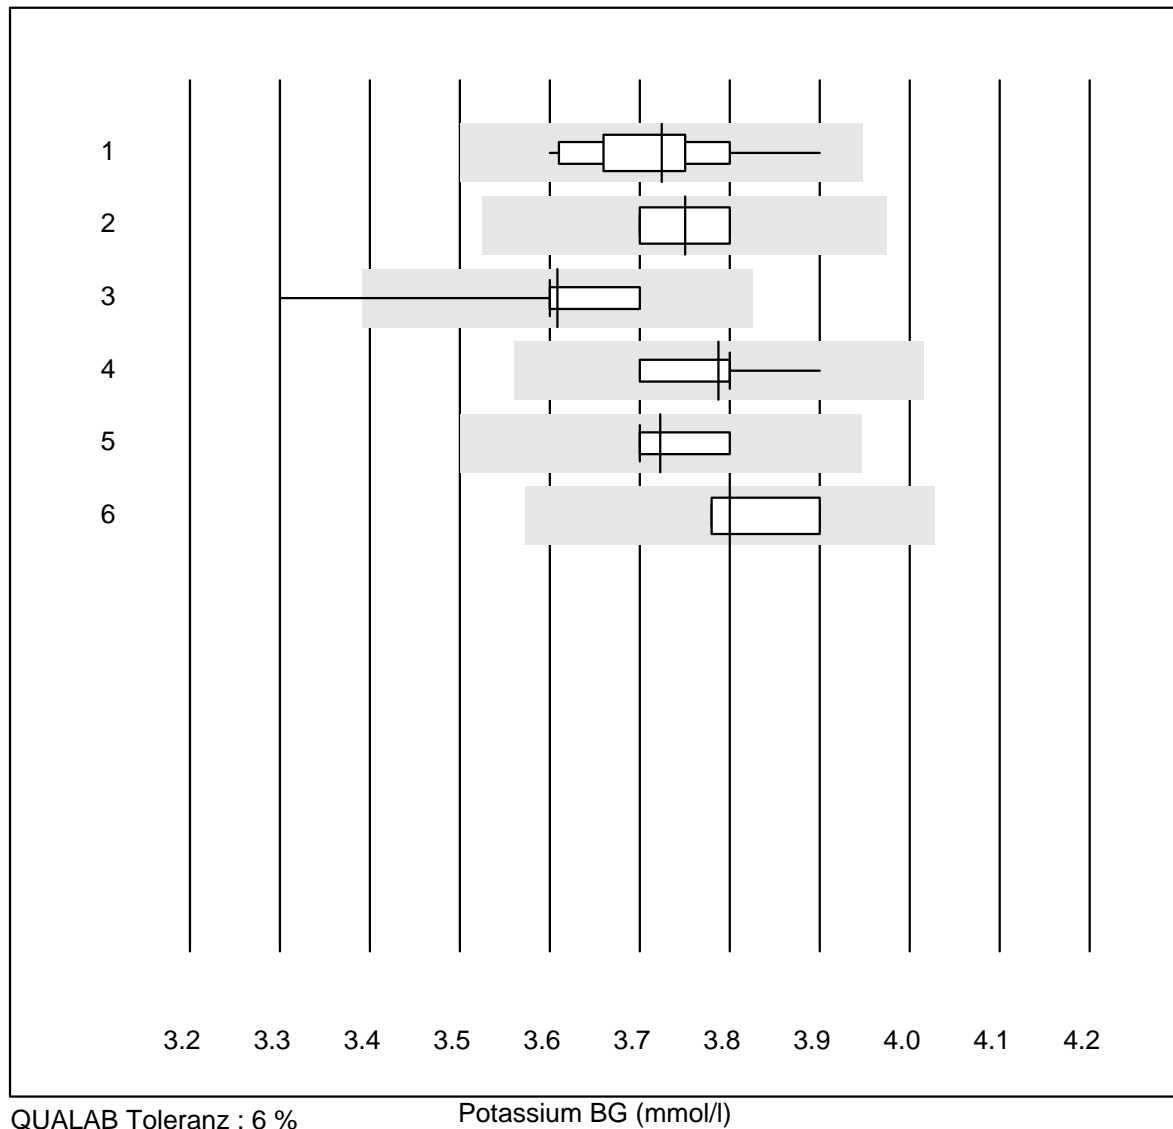


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas b 123	12	100.0	0.0	0.0	3.7	2.3	e
2 iStat	22	100.0	0.0	0.0	3.8	1.4	e
3 EPOC	35	97.1	2.9	0.0	3.6	2.1	e
4 ABL700/800	74	100.0	0.0	0.0	3.8	1.0	e
5 ABL90 FLEX / PLUS	74	100.0	0.0	0.0	3.7	1.1	e
6 ABL80 FLEX CO-OX / O	7	100.0	0.0	0.0	3.8	1.4	e

## Sodium BG

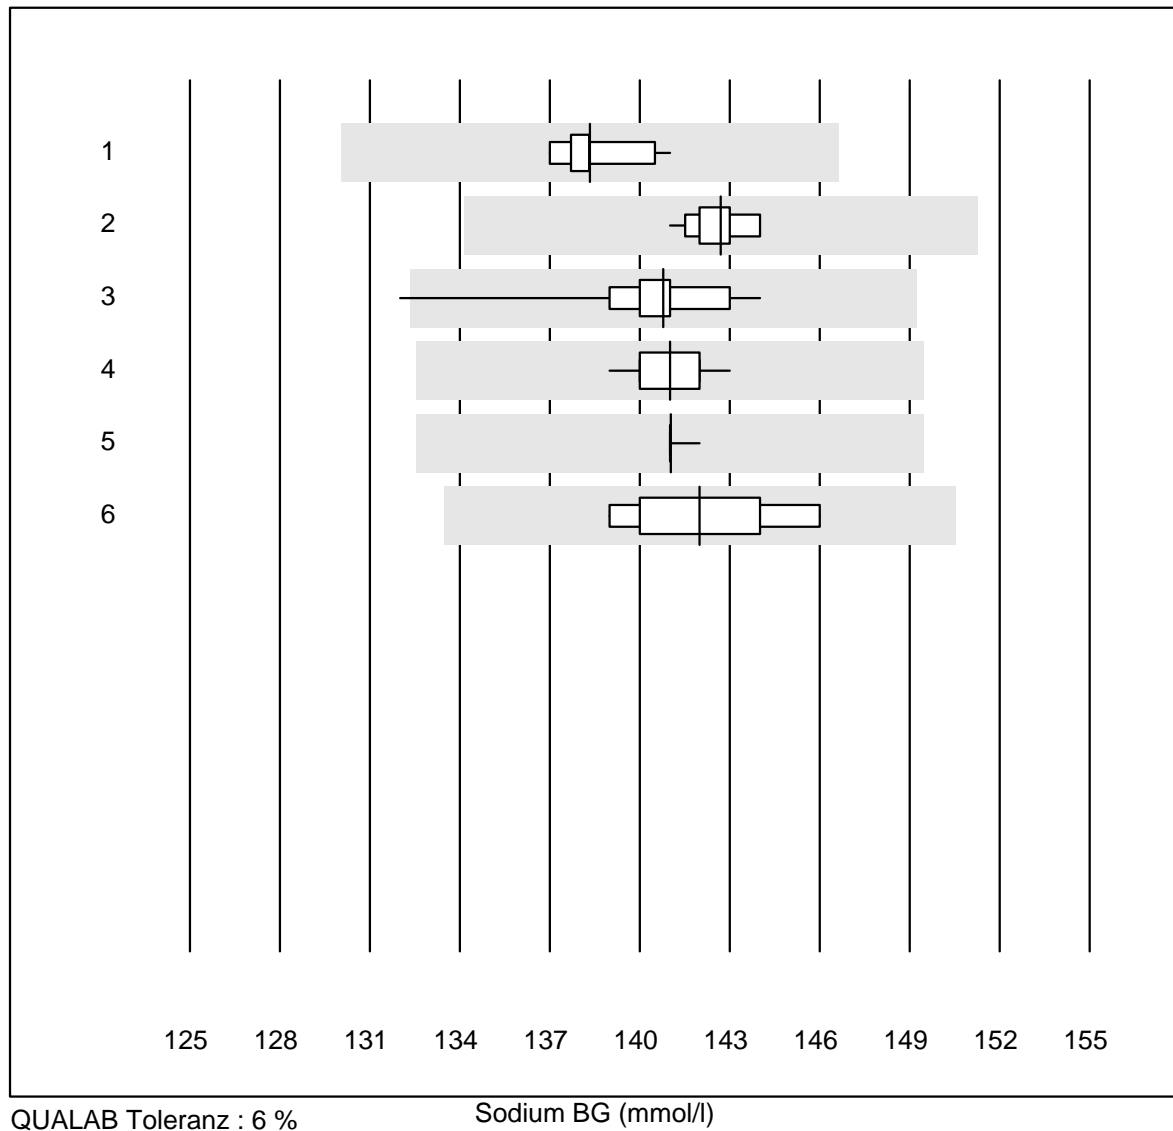

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas b 123	12	100.0	0.0	0.0	138.3	0.9	e
2	iStat	22	100.0	0.0	0.0	142.7	0.6	e
3	EPOC	33	97.0	3.0	0.0	140.8	1.5	e
4	ABL700/800	73	100.0	0.0	0.0	141.0	0.7	e
5	ABL90 FLEX / PLUS	73	100.0	0.0	0.0	141.0	0.1	e
6	ABL80 FLEX CO-OX / O	7	100.0	0.0	0.0	142.0	1.7	e

## Chlorure-BG

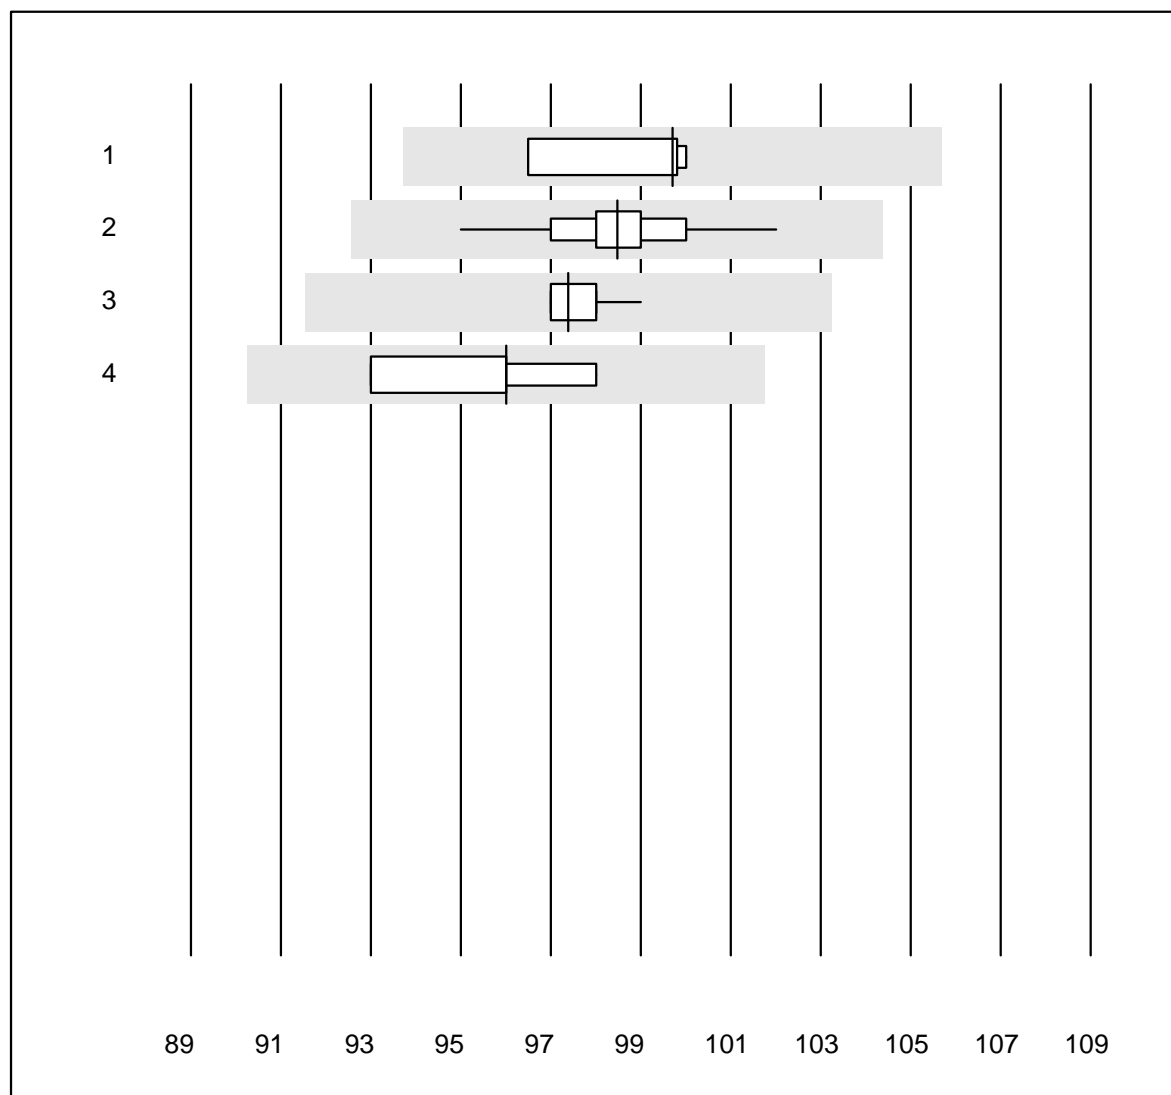


QUALAB Toleranz : 6 %

Chlorure-BG (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas b 123	4	100.0	0.0	0.0	99.7	1.7	e*
2 ABL700/800	67	100.0	0.0	0.0	98.5	1.3	e
3 ABL90 FLEX / PLUS	70	100.0	0.0	0.0	97.4	0.5	e
4 ABL80 FLEX CO-OX / O	4	100.0	0.0	0.0	96.0	2.2	e*

## Calcium-BG

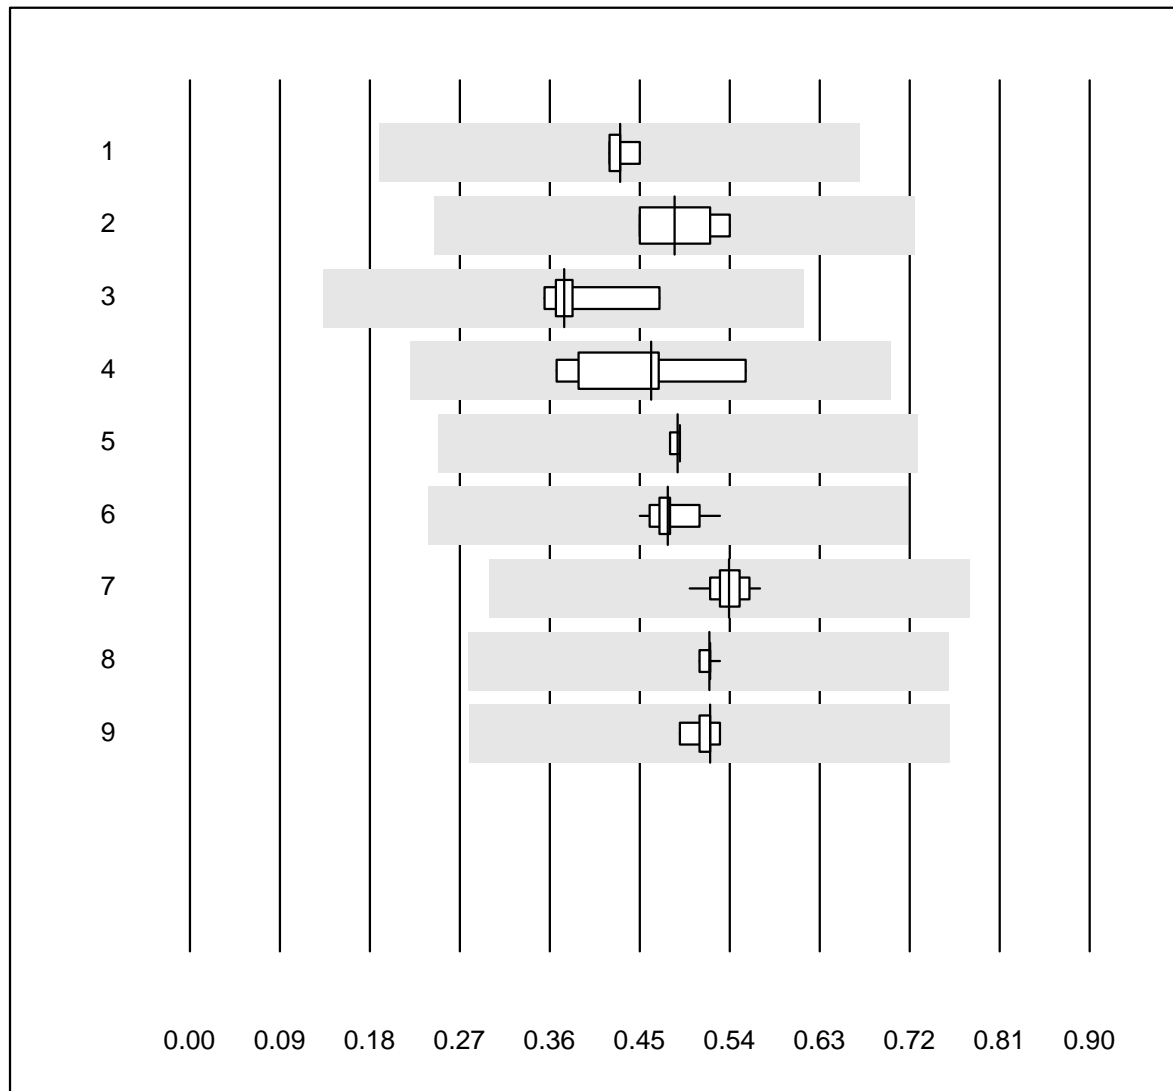


Tolérance MQ : 12 %  
( < 2.00: +/- 0.24 mmol/l)

Calcium-BG (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 GEM	4	100.0	0.0	0.0	0.43	2.9	e*
2 ABL80 FLEX	4	100.0	0.0	0.0	0.49	9.6	e*
3 Cobas b123	5	100.0	0.0	0.0	0.37	11.8	e*
4 Cobas	6	100.0	0.0	0.0	0.46	14.9	e*
5 iStat	13	100.0	0.0	0.0	0.49	0.9	e
6 EPOC	31	93.5	0.0	6.5	0.48	3.8	e
7 ABL700/800	74	100.0	0.0	0.0	0.54	2.8	e
8 ABL90 FLEX / PLUS	72	100.0	0.0	0.0	0.52	1.0	e
9 ABL80 FLEX CO-OX / O	6	100.0	0.0	0.0	0.52	2.7	e

## FHHb

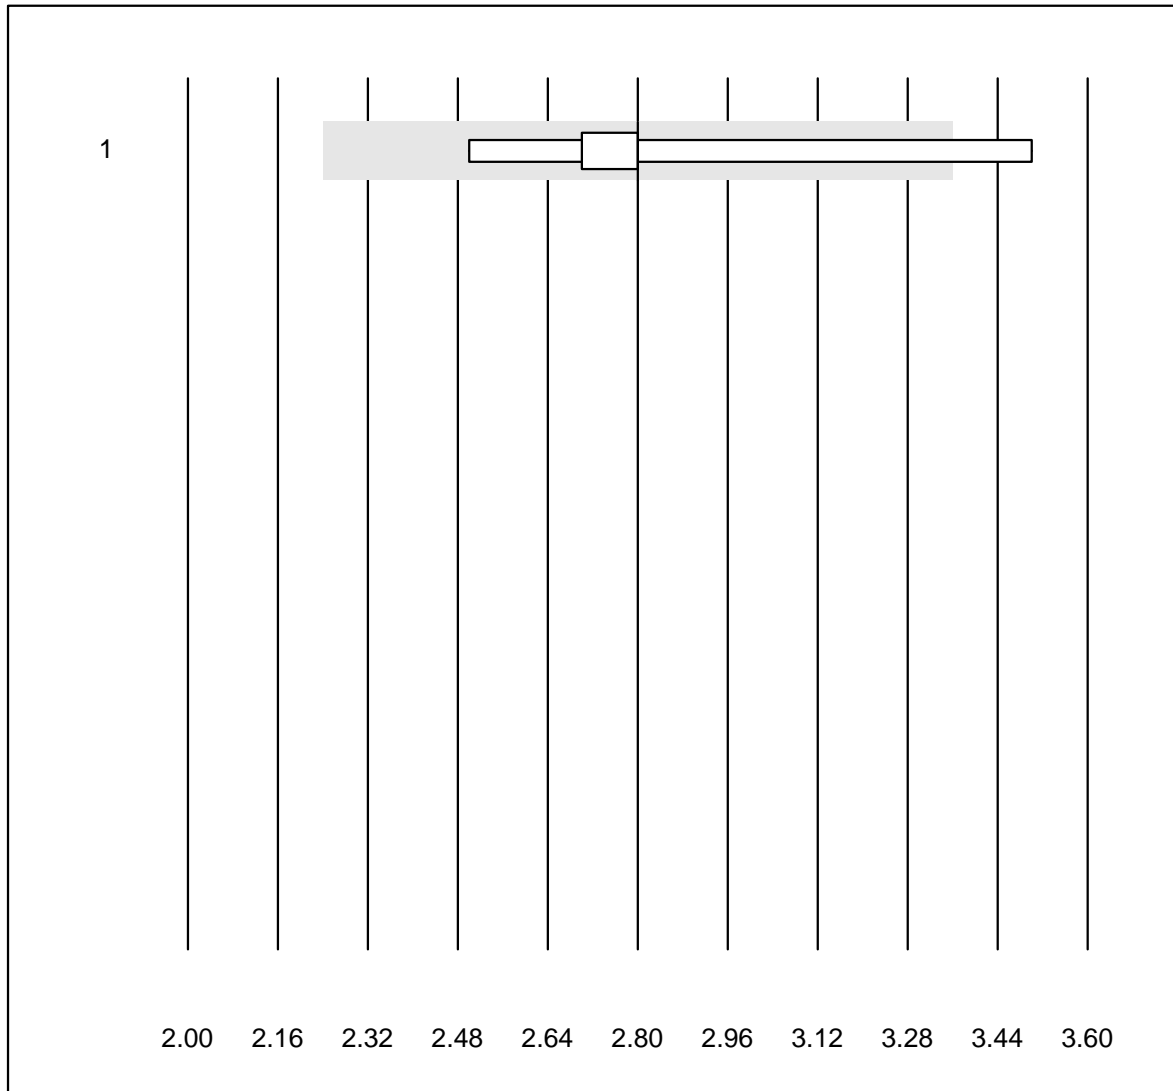


Tolérance MQ : 20 %

FHHb (%)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL80 FLEX CO-OX / O	5	80.0	20.0	0.0	2.800	13.2	e*

## Lactate-BG

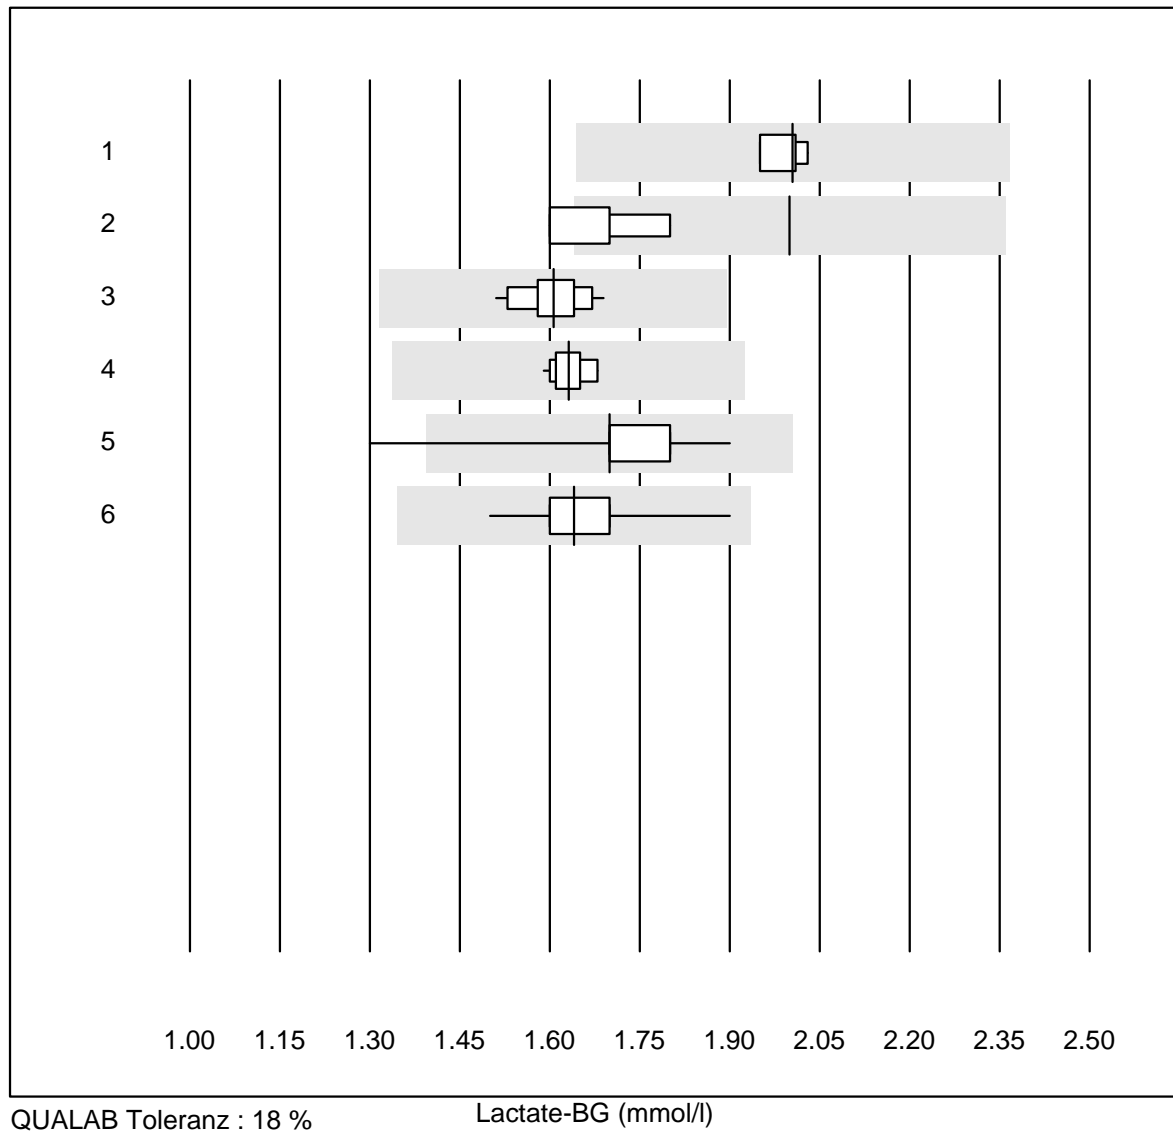

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	2.01	1.7	e
2 IL	4	75.0	25.0	0.0	2.00	4.9	a
3 EPOC	35	94.3	0.0	5.7	1.61	2.9	e
4 iStat	15	100.0	0.0	0.0	1.63	1.7	e
5 ABL700/800	77	98.7	1.3	0.0	1.70	5.0	e
6 ABL90 FLEX / PLUS	74	100.0	0.0	0.0	1.64	4.4	e

## sO2 OR

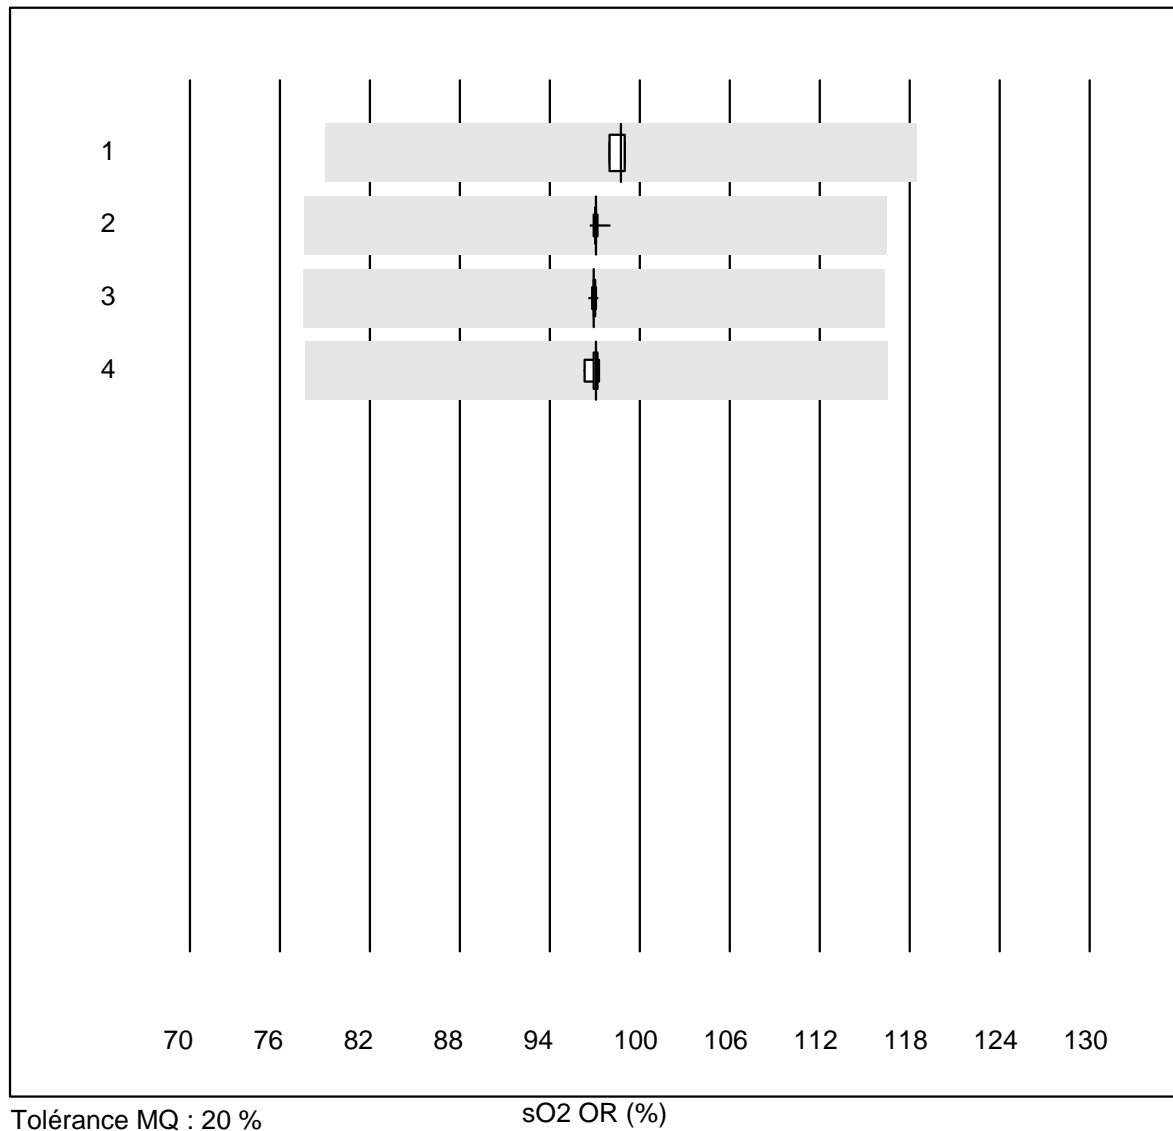


Tolérance MQ : 20 %

sO2 OR (%)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 iStat	12	100.0	0.0	0.0	98.750	0.5	e
2 ABL700/800	54	100.0	0.0	0.0	97.072	0.2	e
3 ABL90 FLEX / PLUS	63	100.0	0.0	0.0	96.949	0.1	e
4 ABL80 FLEX CO-OX / O	9	100.0	0.0	0.0	97.100	0.3	e

## FO2Hb OR

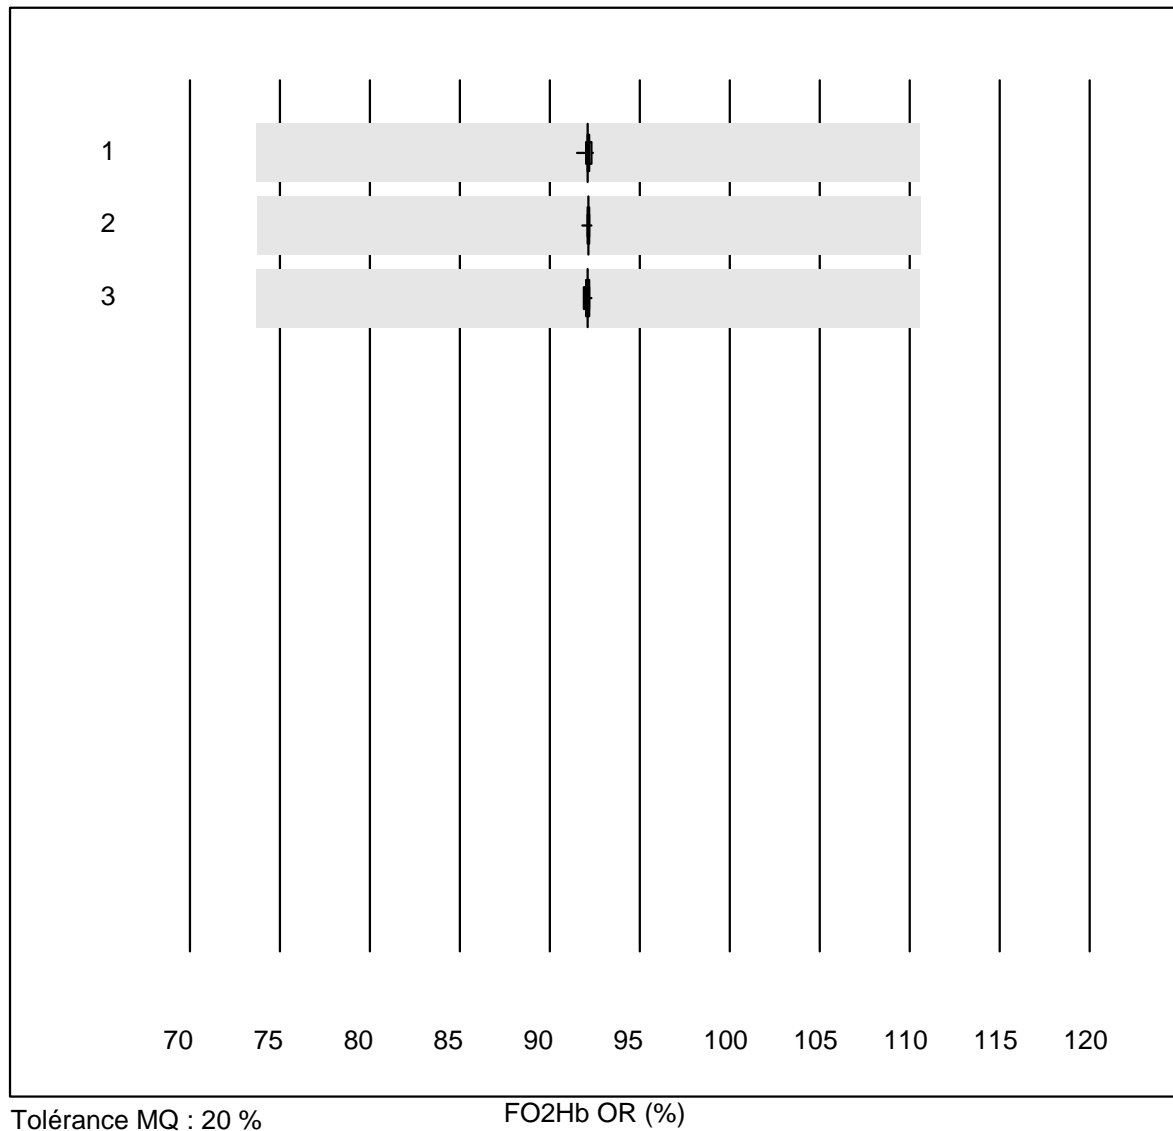


Tolérance MQ : 20 %

FO2Hb OR (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL700/800	53	100.0	0.0	0.0	92.119	0.2	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	63	100.0	0.0	0.0	92.151	0.1	e
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	11	100.0	0.0	0.0	92.109	0.1	e



## FCOHb OR

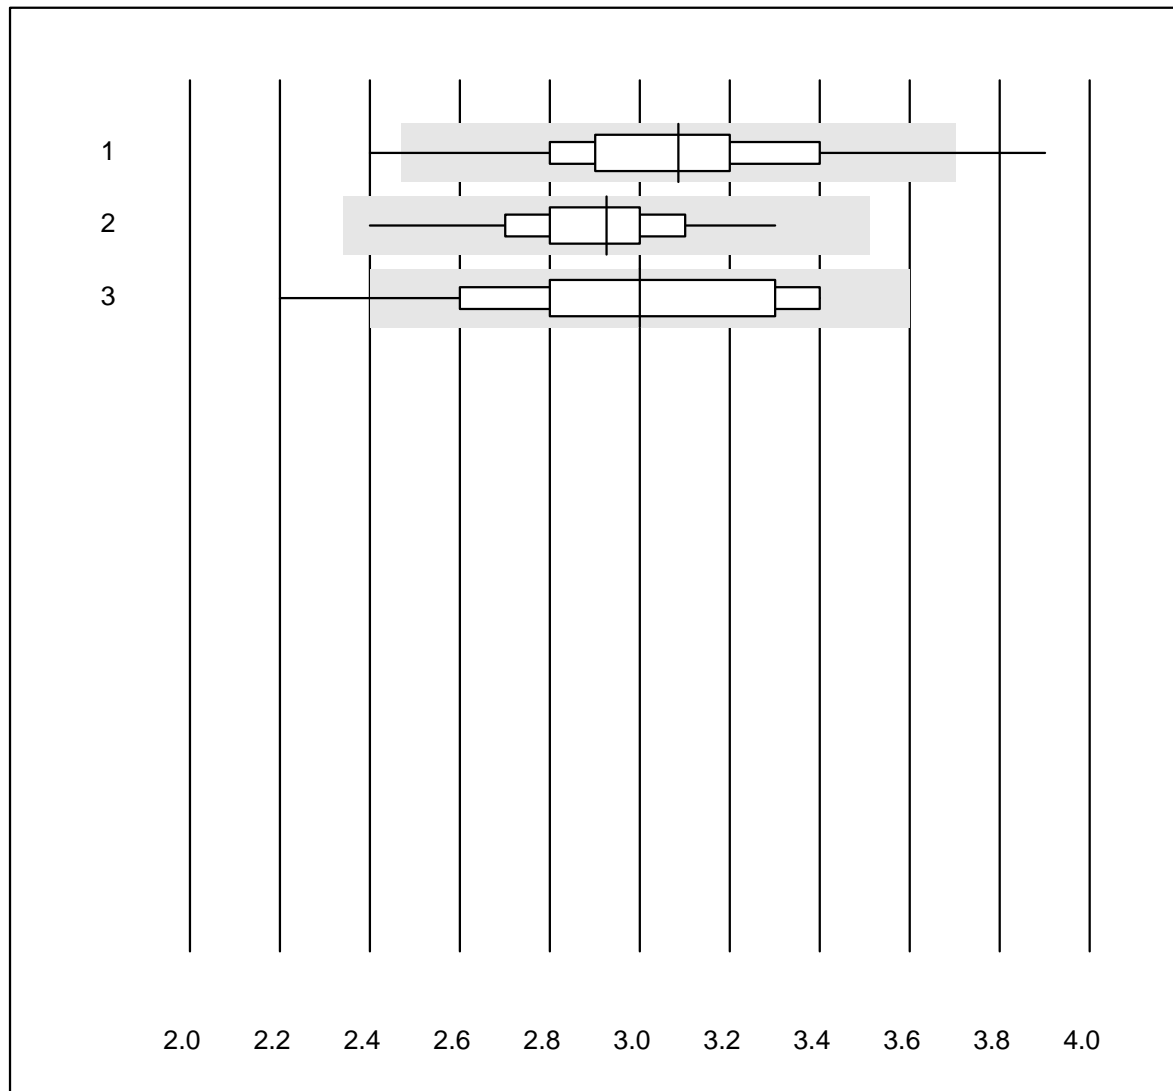


Tolérance MQ : 20 %

FCOHb OR (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL700/800	55	90.9	7.3	1.8	3.085	9.1	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	62	100.0	0.0	0.0	2.926	5.5	e
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	11	90.9	9.1	0.0	3.000	12.1	e*

## FMetHb OR

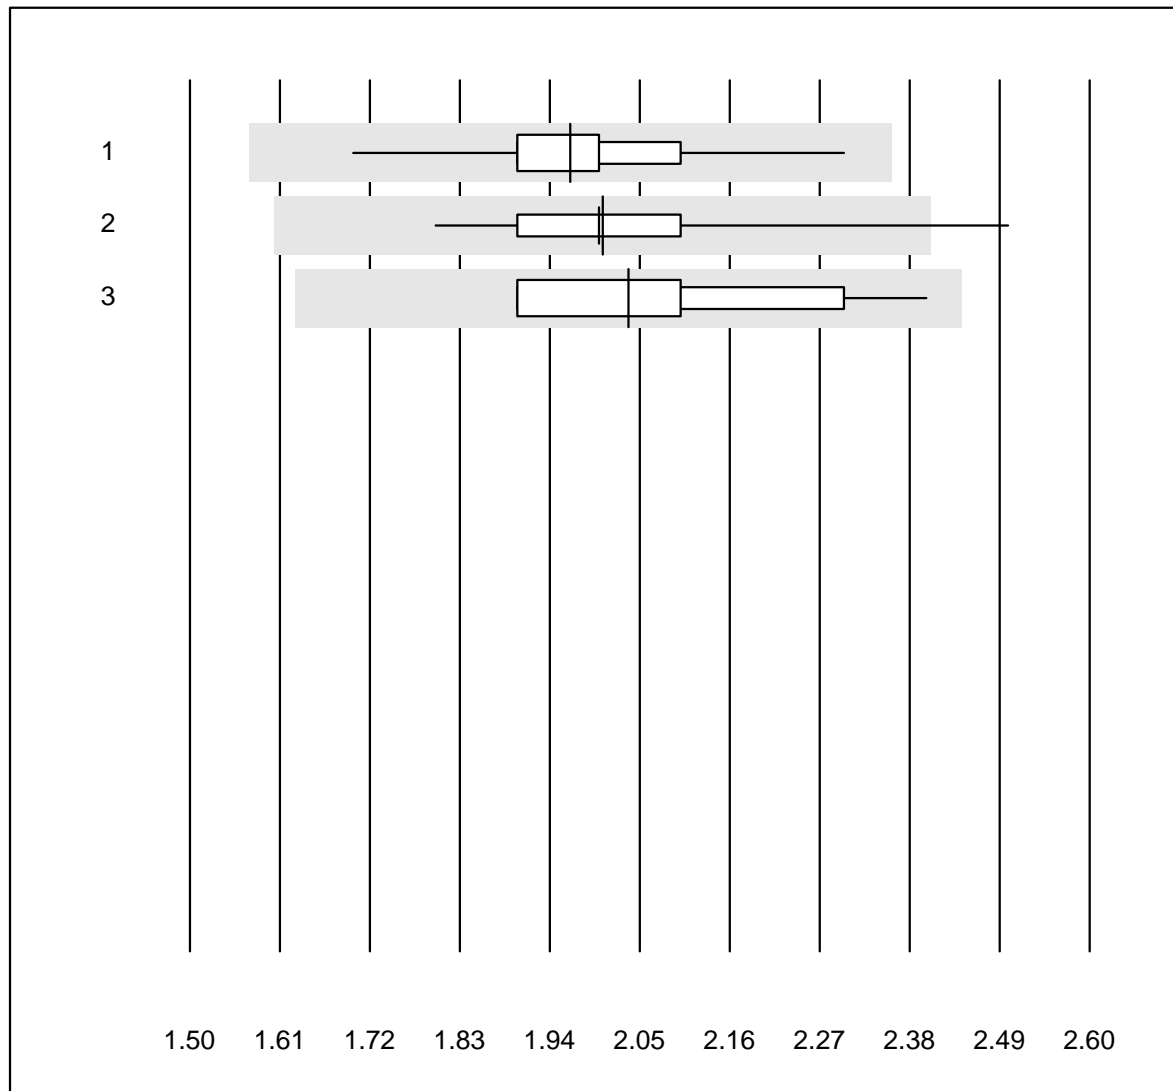


Tolérance MQ : 20 %

FMetHb OR (%)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 ABL700/800	57	100.0	0.0	0.0	1.965	5.5	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	62	98.4	1.6	0.0	2.005	4.8	e
3 ABL80 FLEX CO-OX / O	11	100.0	0.0	0.0	2.036	8.3	e*


## FHbF OR

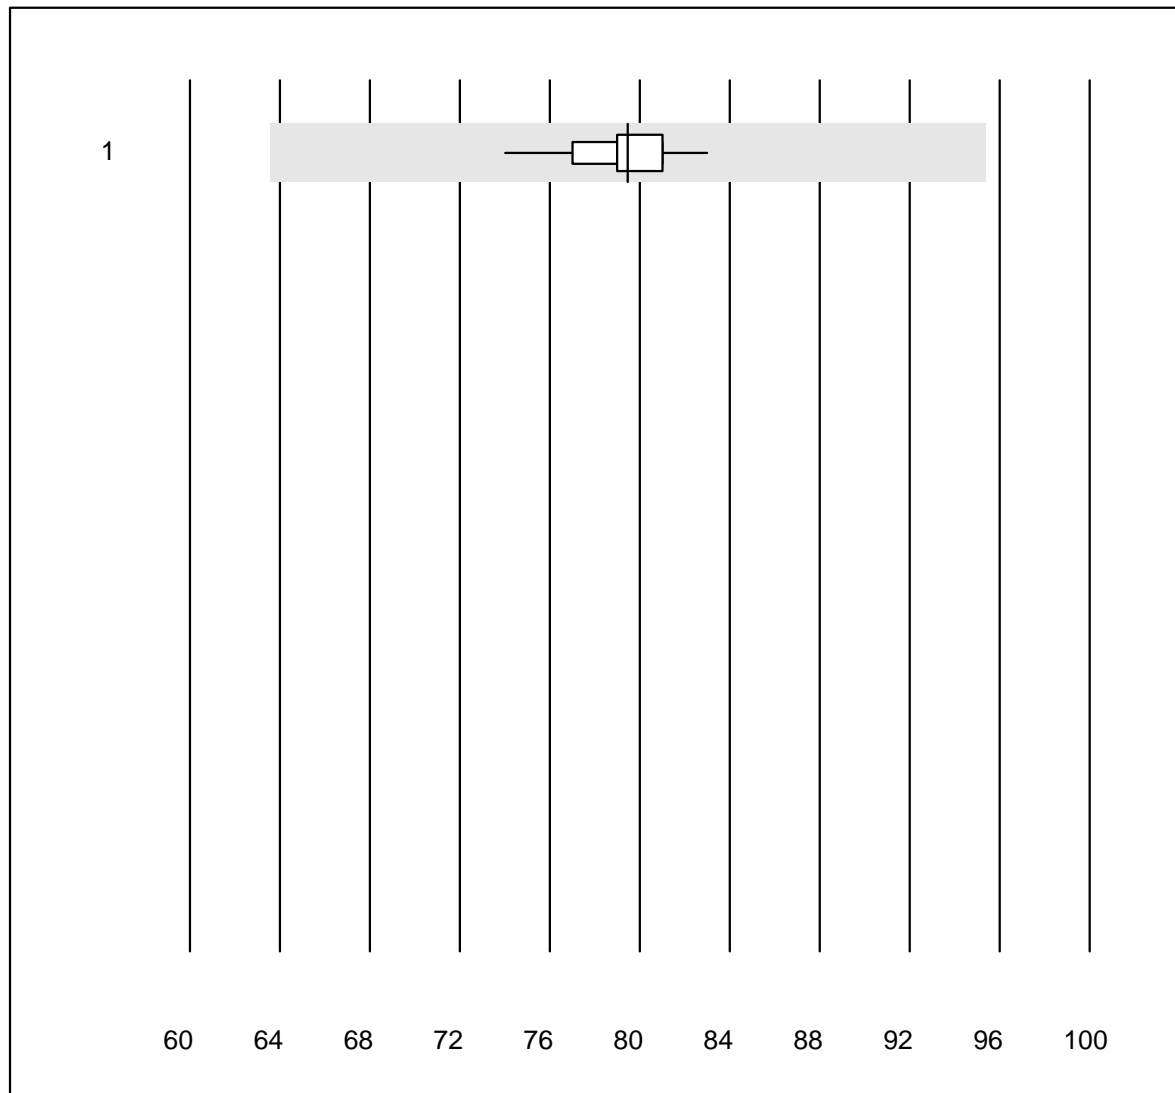

Tolérance MQ : 20 %

FHbF OR (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL90 FLEX / PLUS	15	100.0	0.0	0.0	79.467	2.7	e

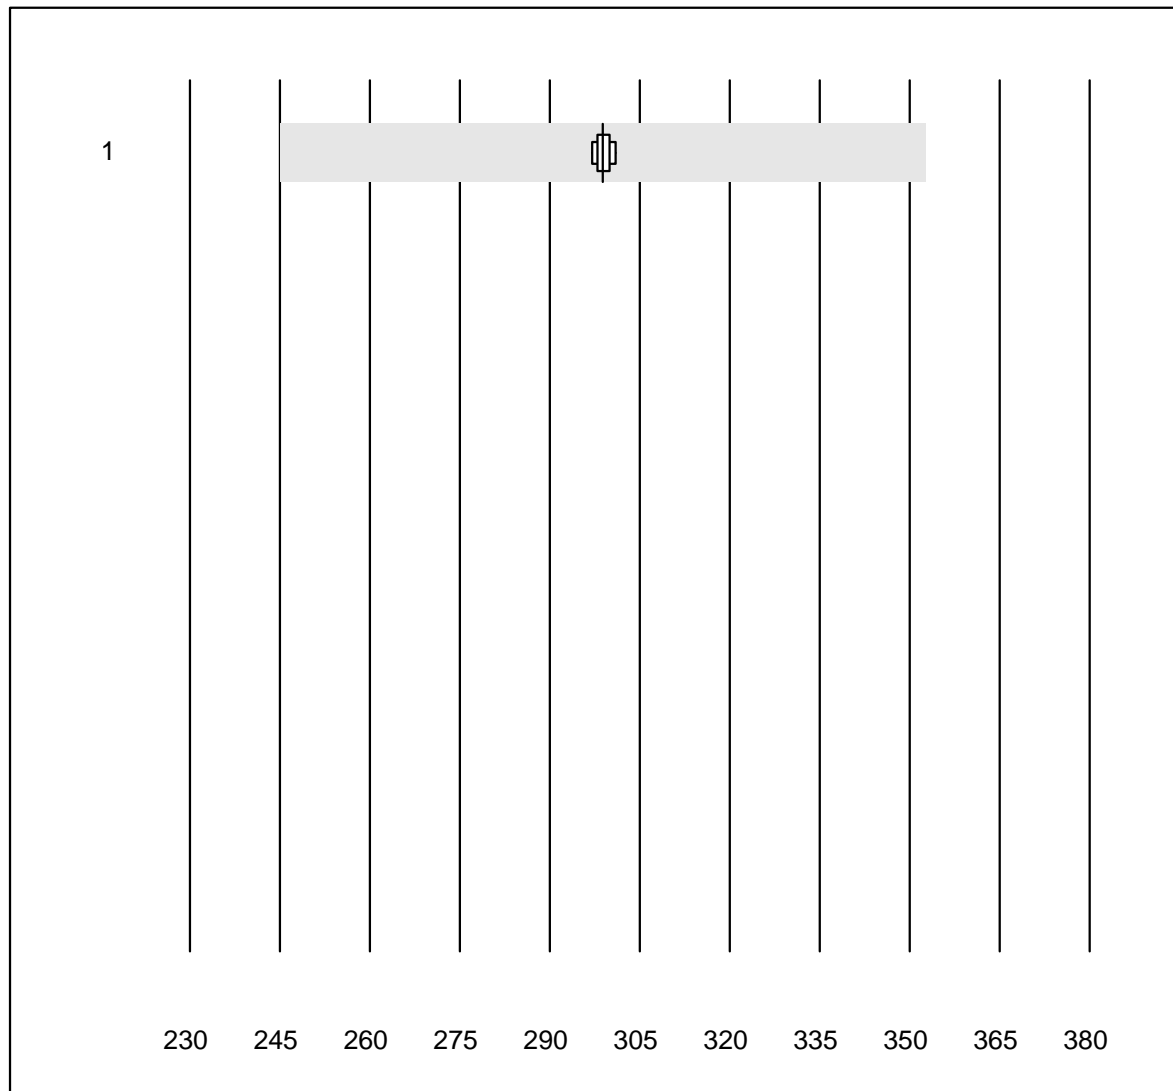
**Bilirubin OR**

QUALAB Toleranz : 18 %

Bilirubin OR (µmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL90 FLEX / PLUS	26	100.0	0.0	0.0	298.8	0.4	e

## Troponine I

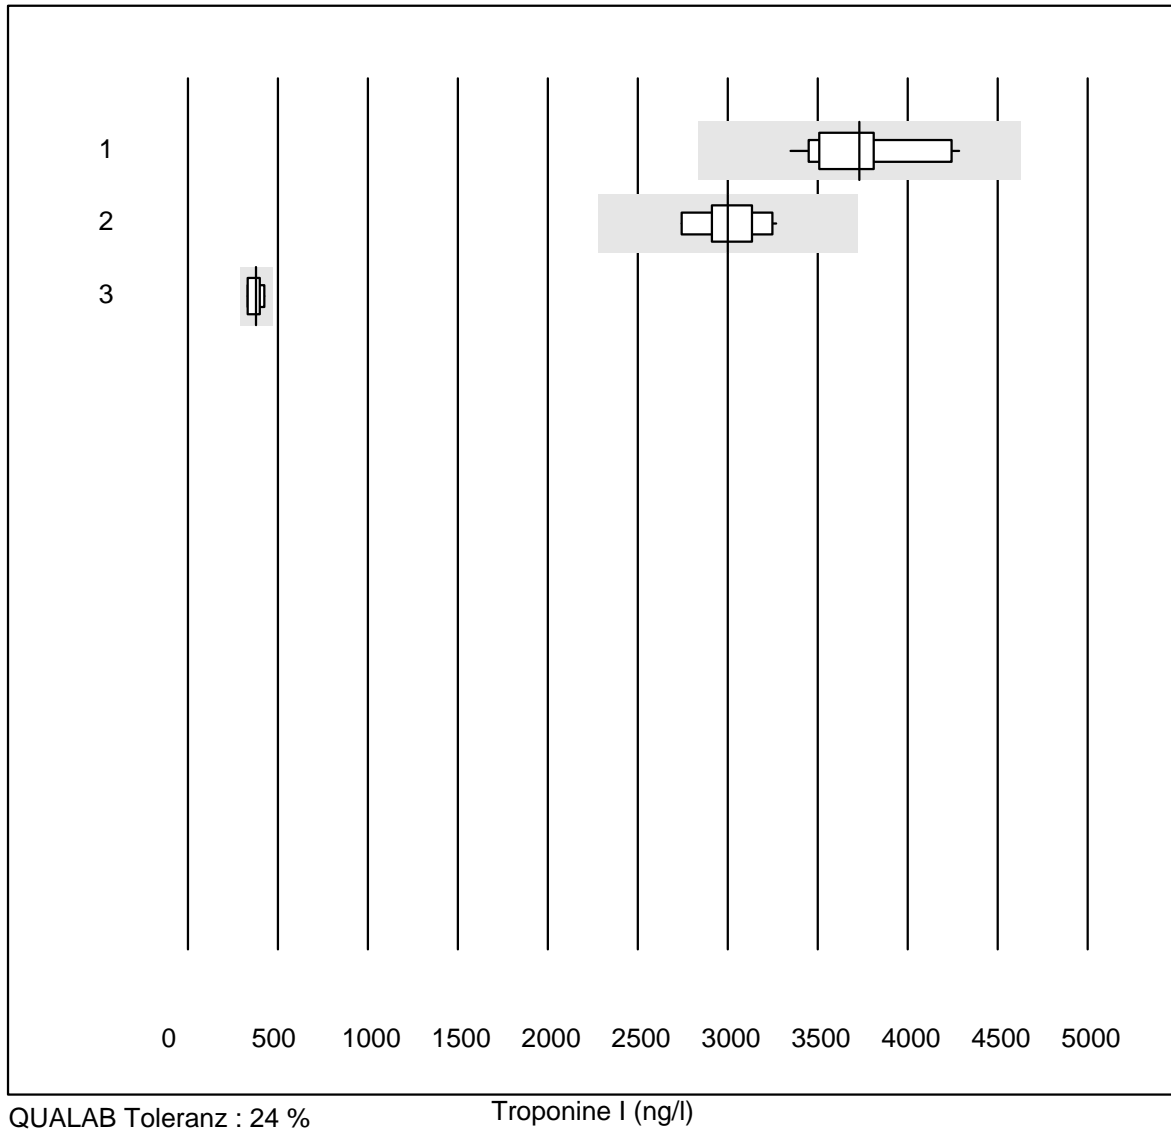


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Vidas	12	100.0	0.0	0.0	3731.9	8.1	e
2 Architect High Sensi	10	100.0	0.0	0.0	3001.8	6.0	e
3 AQT 90 FLEX	7	100.0	0.0	0.0	380.0	9.3	e*

## Troponine T

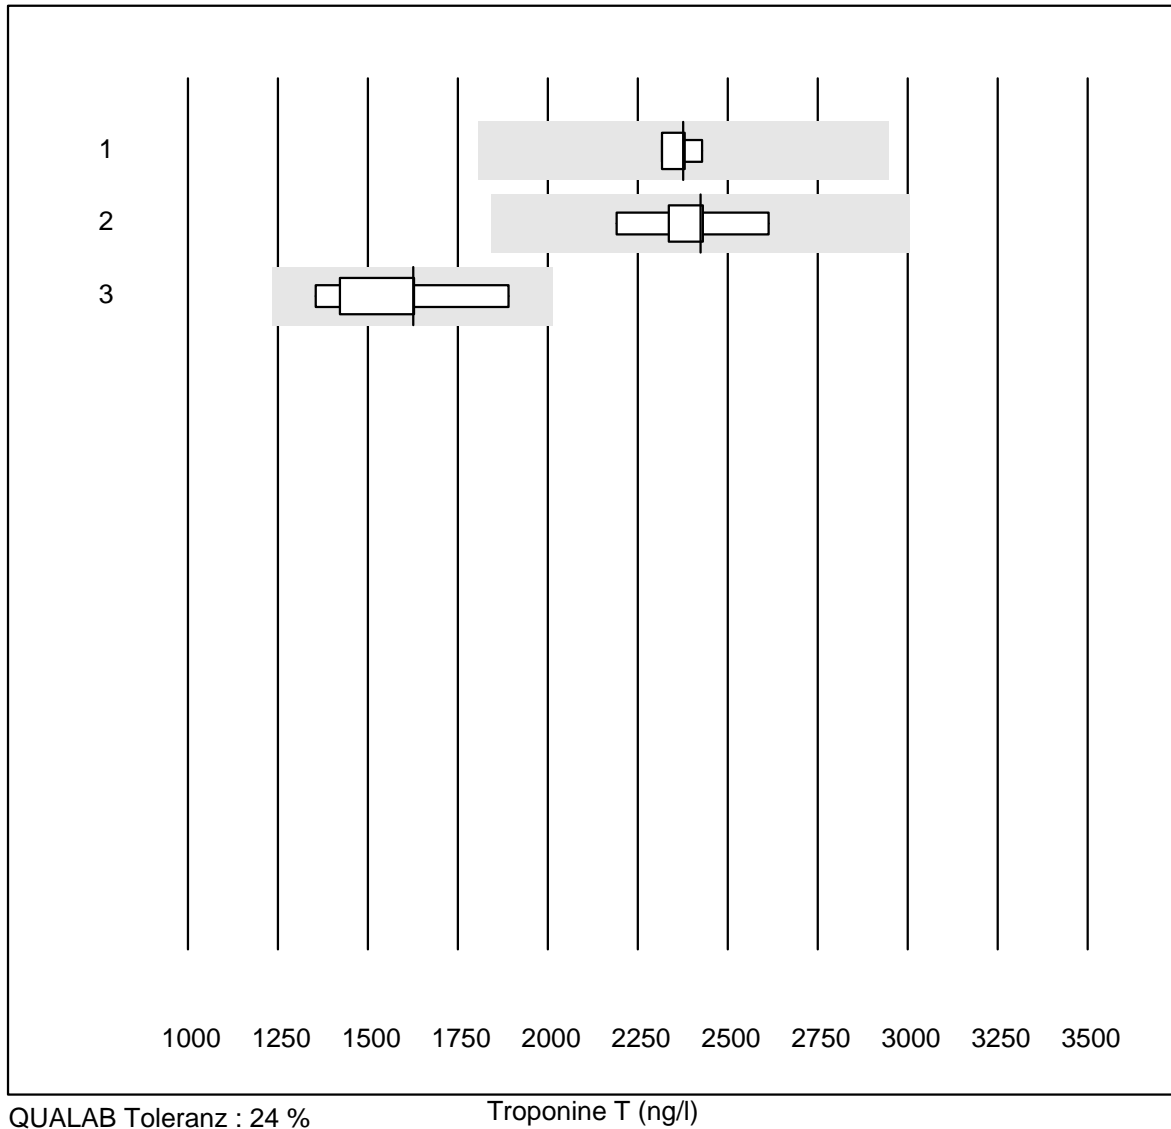

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas hs	4	100.0	0.0	0.0	2376.50	1.9	e
2	Cobas hs STAT	9	100.0	0.0	0.0	2424.00	5.4	e
3	Cobas E / Elecsys	5	100.0	0.0	0.0	1625.00	13.3	e*

## Myoglobine

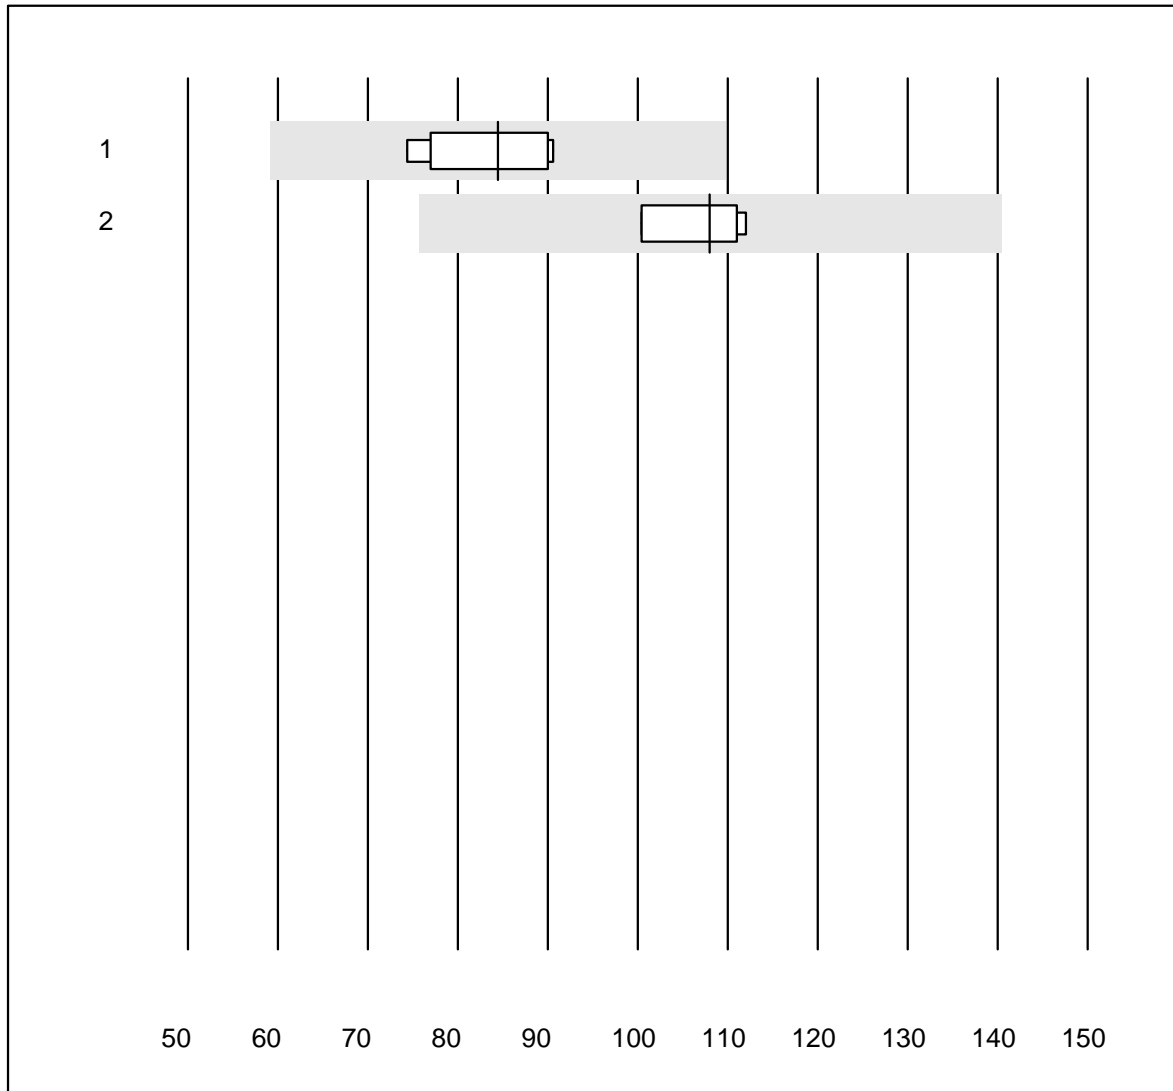


QUALAB Toleranz : 30 %

Myoglobine (µg/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	6	100.0	0.0	0.0	84.5	8.4	e
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	108.0	5.1	e

## masse CK-MB

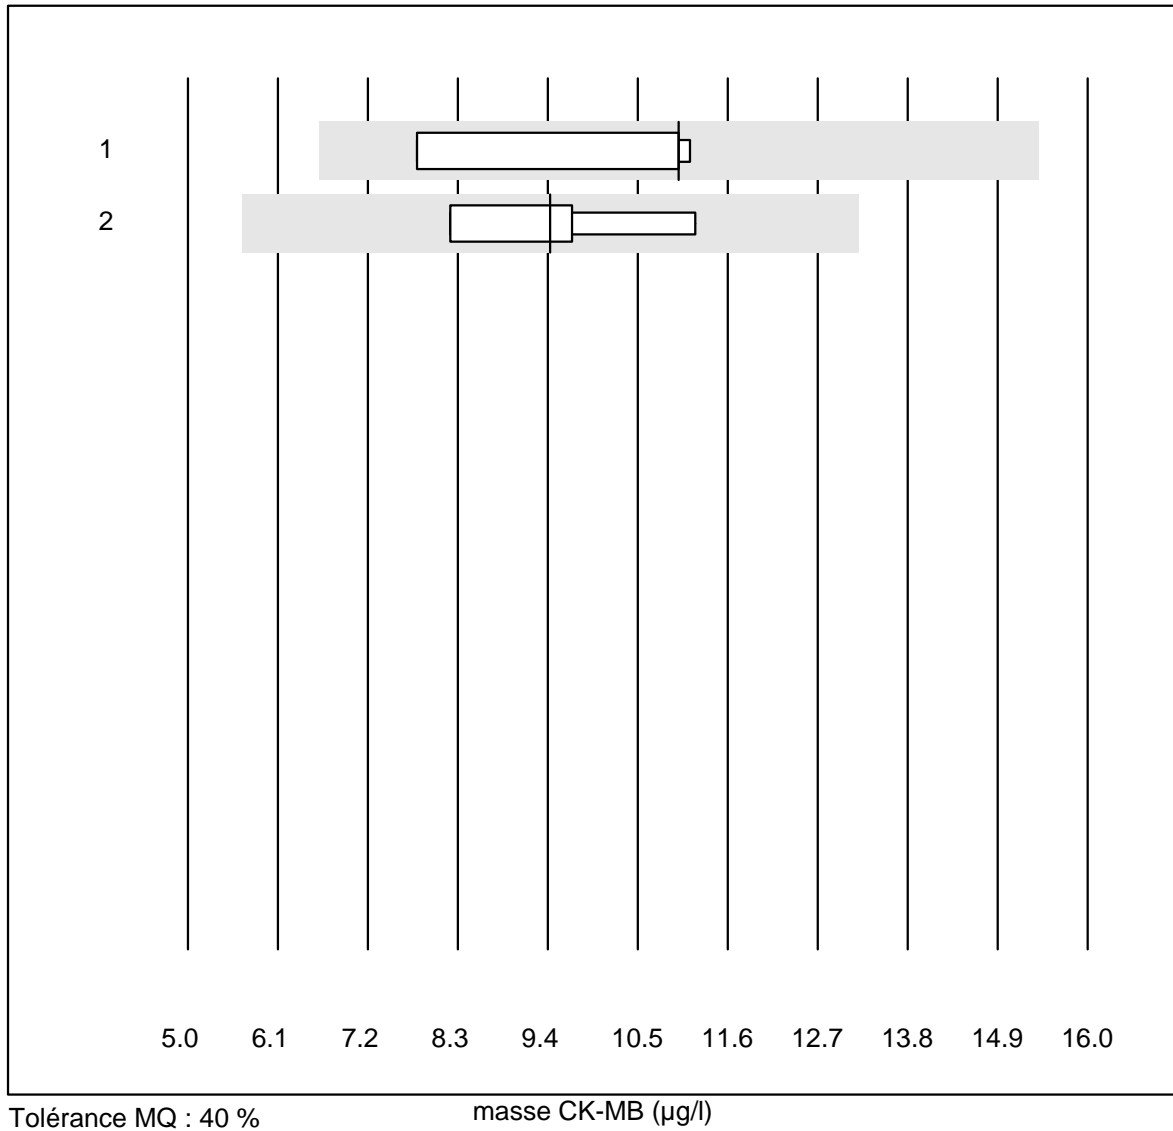


Tolérance MQ : 40 %

masse CK-MB (µg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Architect	4	100.0	0.0	0.0	11.0	15.9	e*
2	Cobas E / Elecsys	4	100.0	0.0	0.0	9.4	13.1	e*




## NT-proBNP

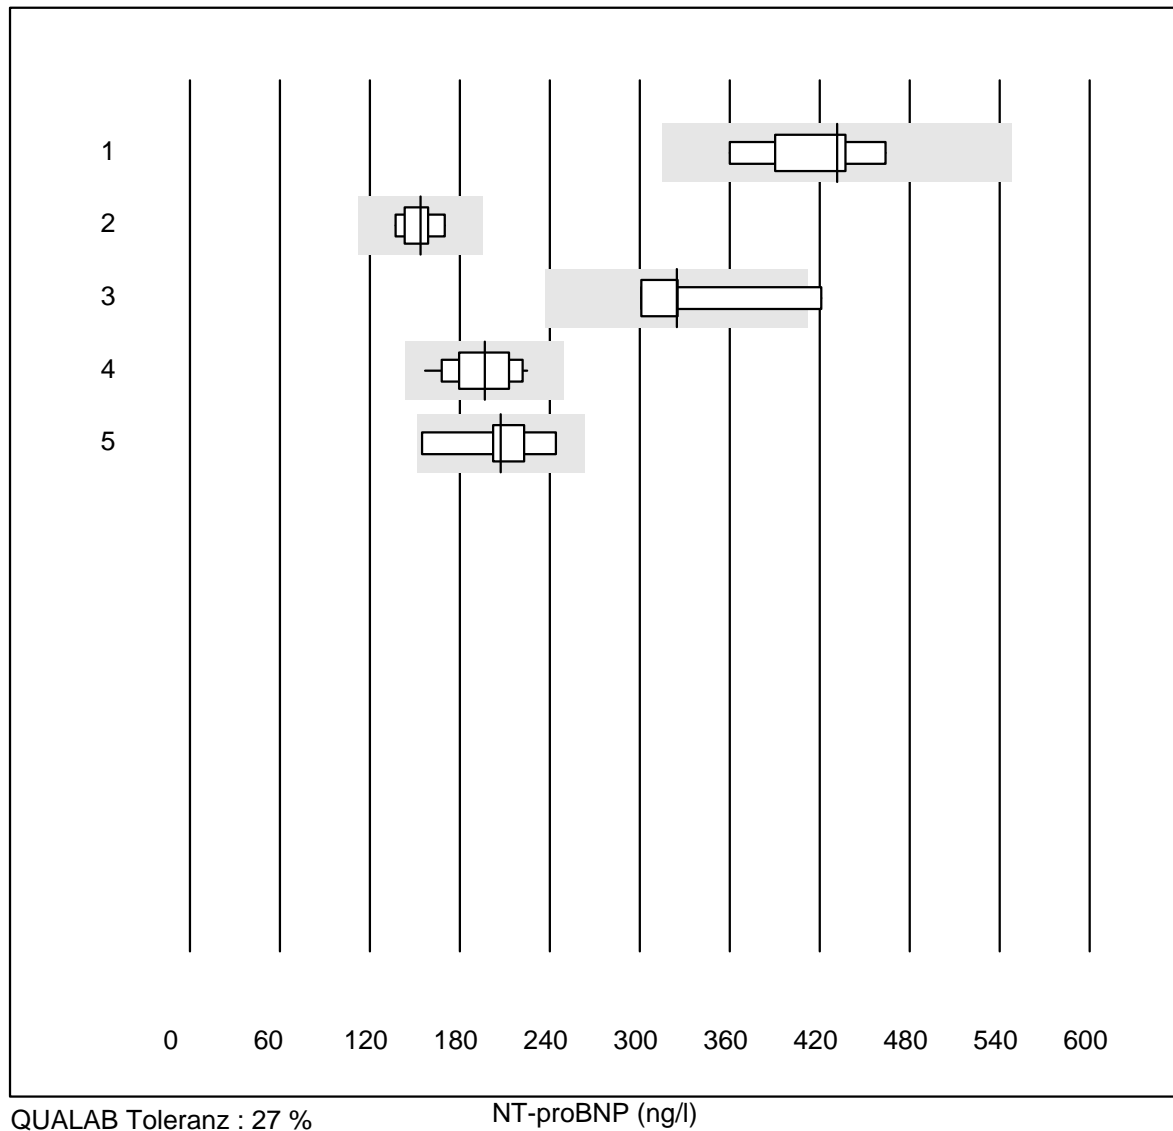


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	AQT 90 FLEX	8	100.0	0.0	0.0	431.5	8.1	e
2	VIDAS	8	100.0	0.0	0.0	154.0	7.4	e
3	Autres méthodes	4	75.0	25.0	0.0	324.5	15.6	e*
4	Cobas E / Elecsys	15	100.0	0.0	0.0	196.7	10.1	e
5	Architect	5	100.0	0.0	0.0	207.2	16.0	e*

## TSH

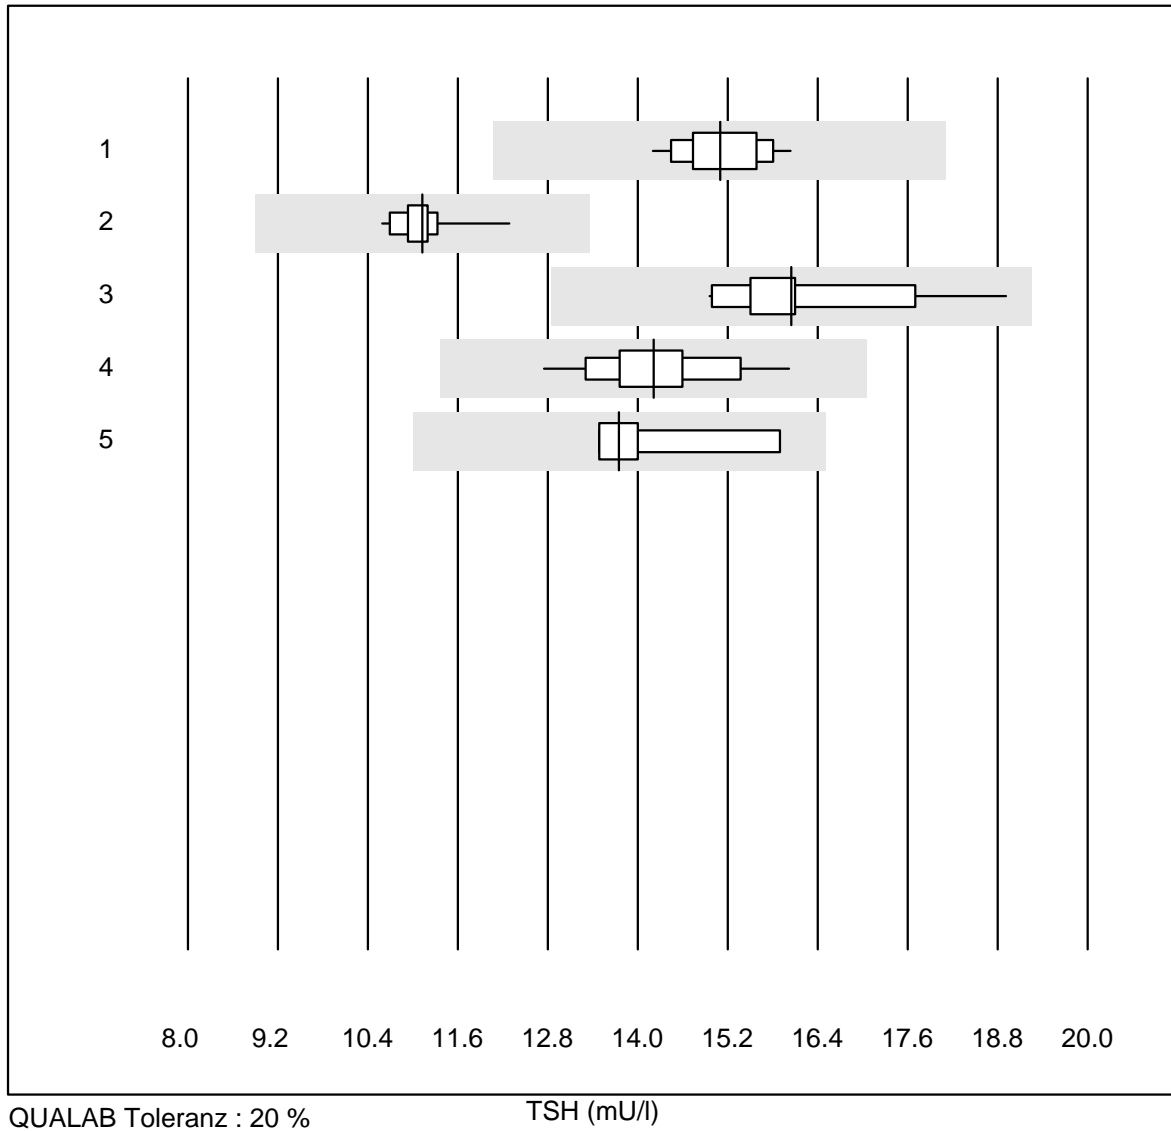

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	15	100.0	0.0	0.0	15.10	3.5	e
2 Architect	13	100.0	0.0	0.0	11.13	3.7	e
3 VIDAS	16	100.0	0.0	0.0	16.05	6.3	e
4 AFIAS	38	94.7	0.0	5.3	14.21	5.3	e
5 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	13.75	8.0	e*


# T3

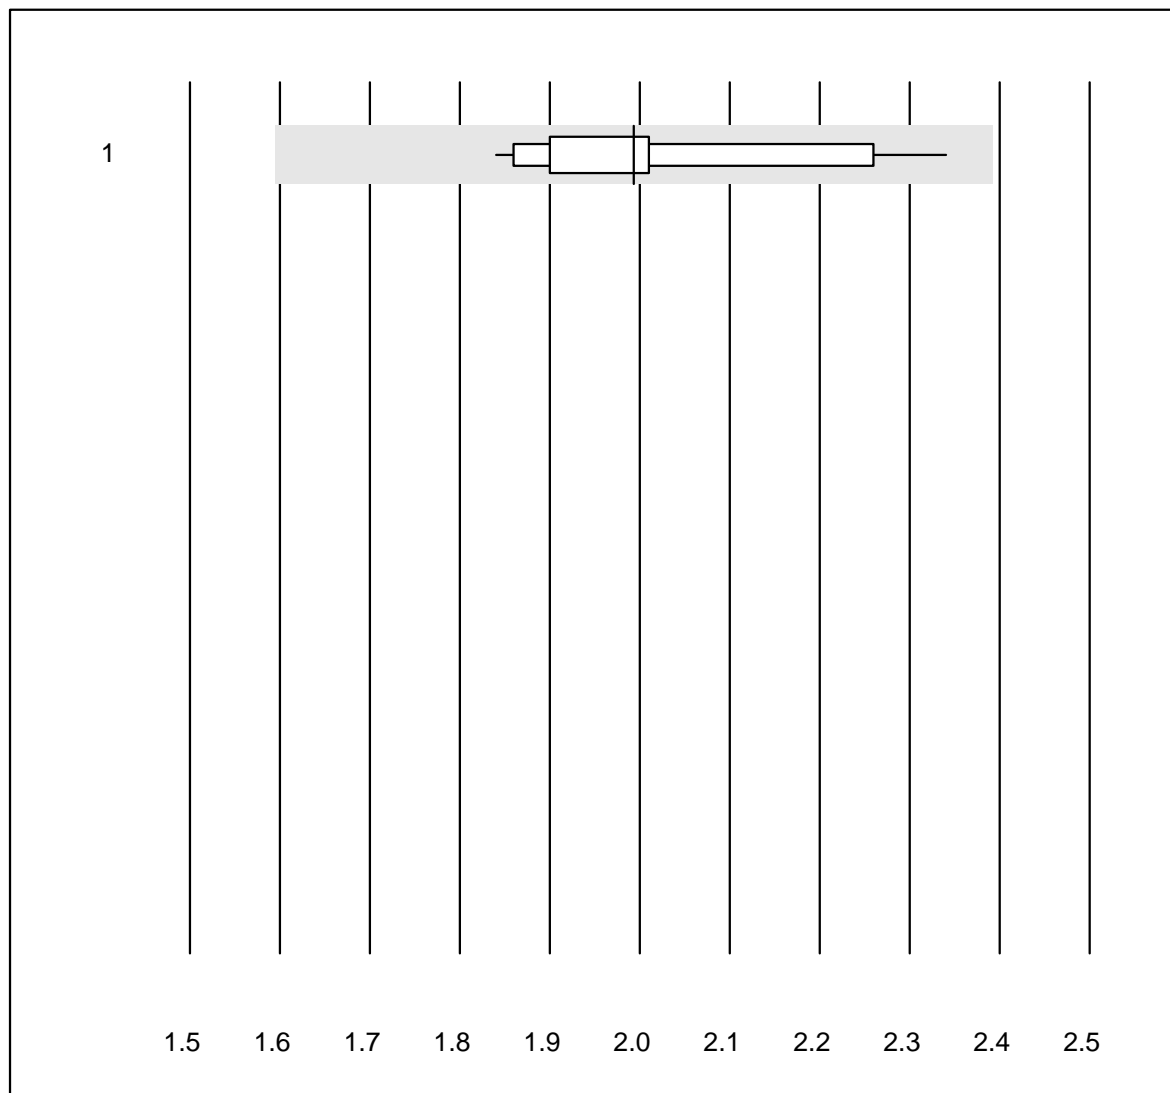

Tolérance MQ : 20 %


T3 (nmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 AFIAS	11	100.0	0.0	0.0	2.0	8.0	e*

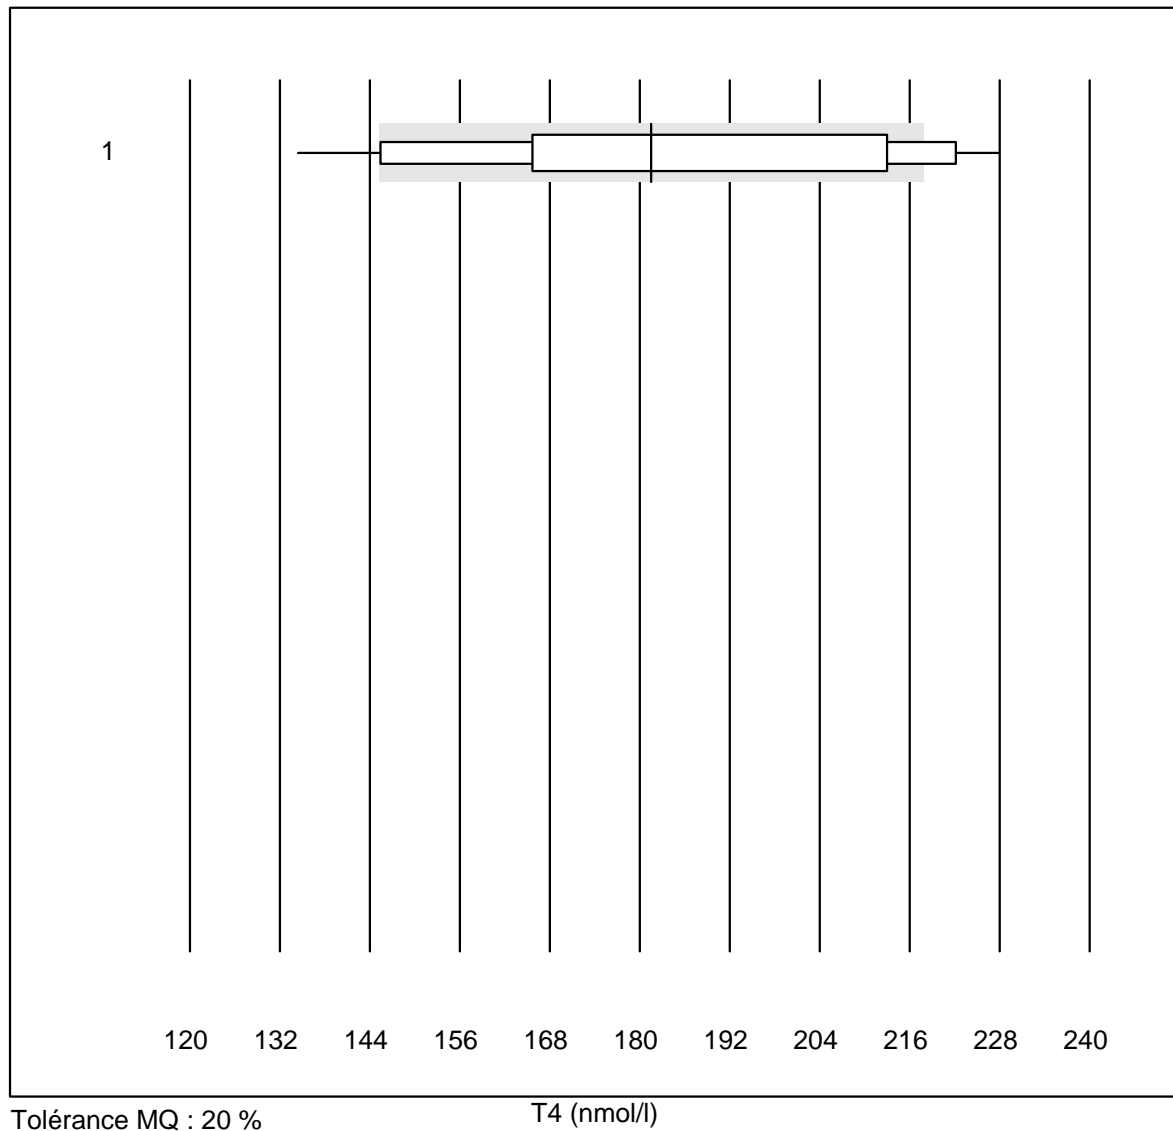
**T4**

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 AFIAS	12	66.7	25.0	8.3	182	16.2	e*

## FT3

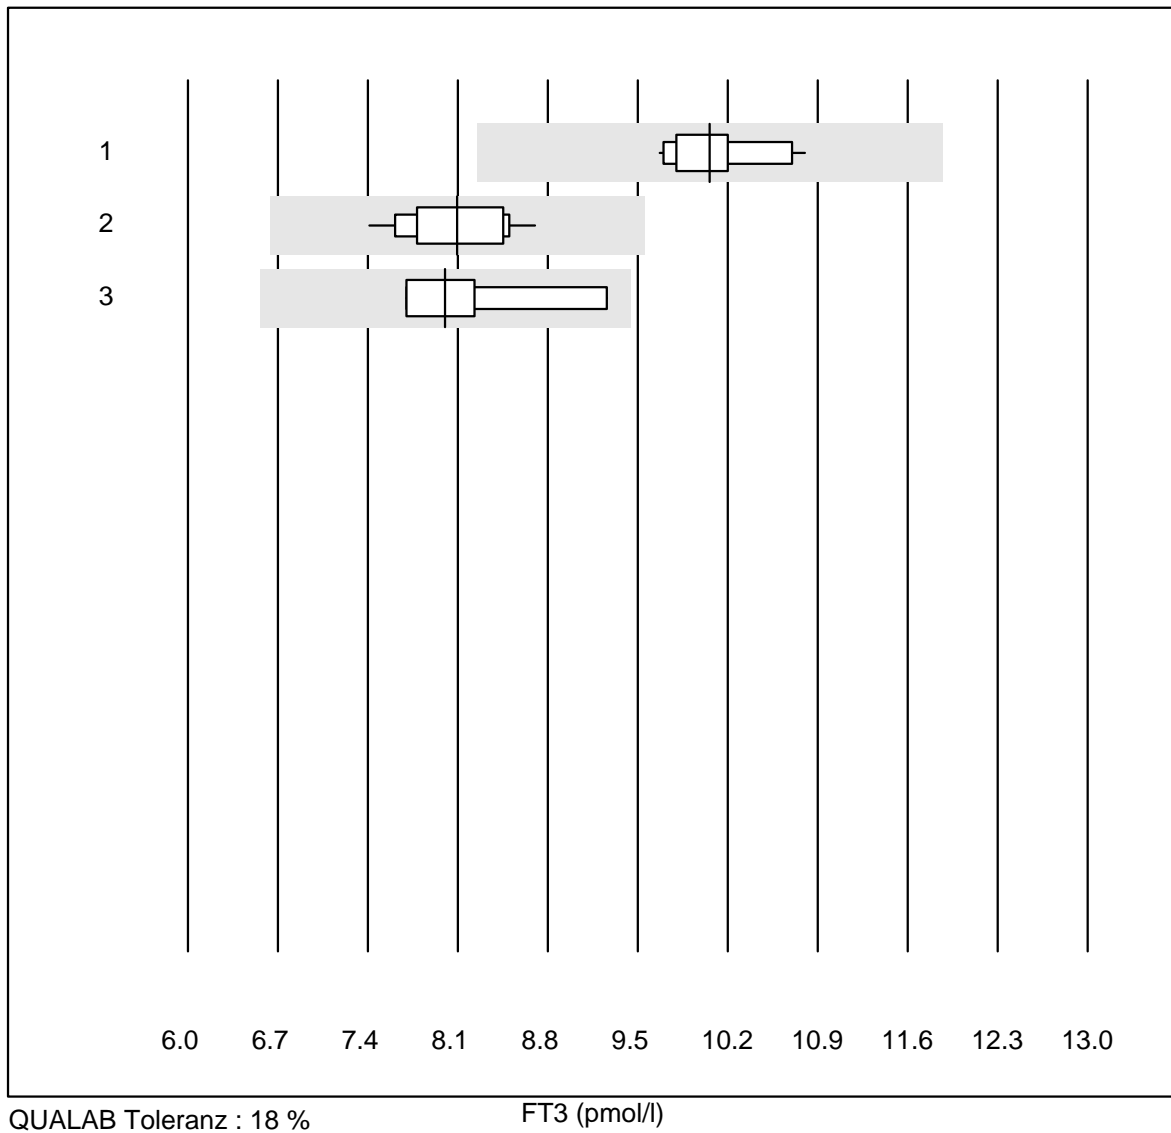

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	15	93.3	0.0	6.7	10.1	3.4	e
2 Architect	11	100.0	0.0	0.0	8.1	4.9	e
3 VIDAS	8	100.0	0.0	0.0	8.0	6.3	e*

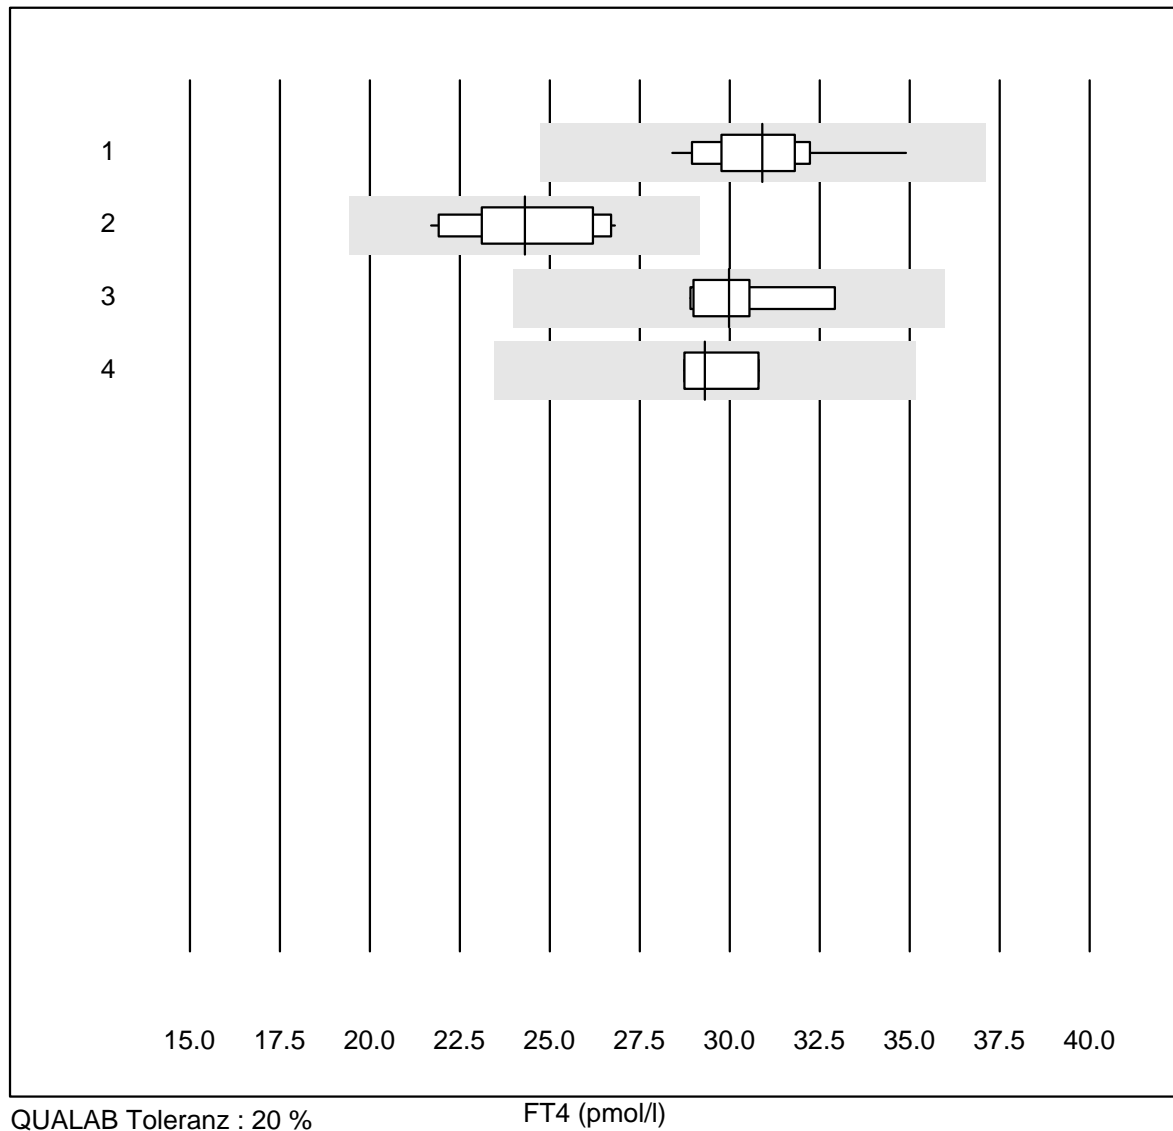
**FT4**

QUALAB Toleranz : 20 %

FT4 (pmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	16	93.7	0.0	6.3	30.9	5.1	e
2	Architect	13	100.0	0.0	0.0	24.3	7.4	e
3	VIDAS	8	100.0	0.0	0.0	30.0	4.7	e
4	Autres méthodes	4	75.0	0.0	25.0	29.3	3.5	e

# Testostérone

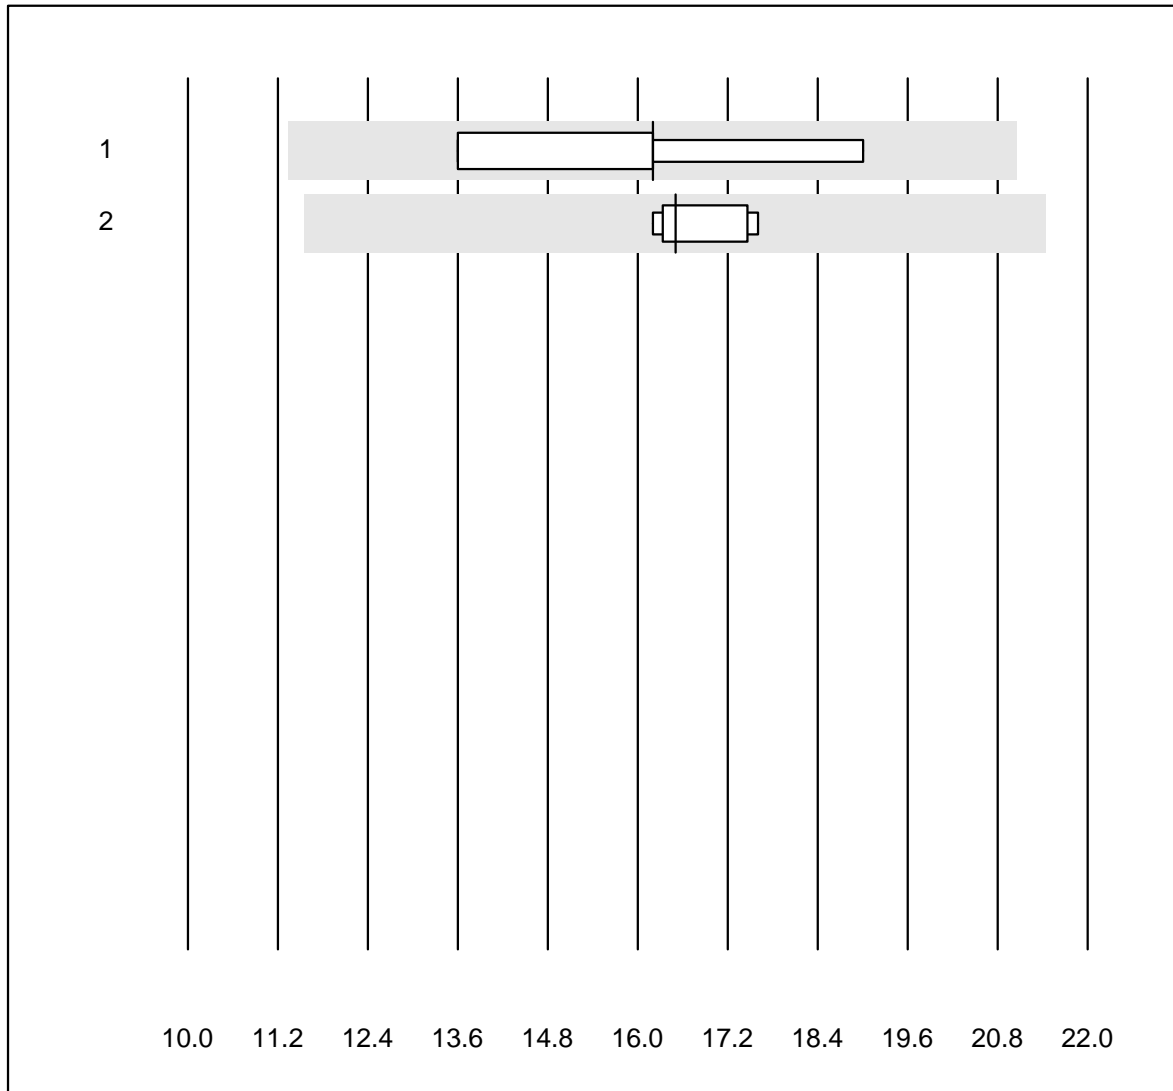


QUALAB Toleranz : 30 %

Testostérone (nmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	5	80.0	0.0	20.0	16.2	14.1	e*
2	Cobas	5	100.0	0.0	0.0	16.5	3.9	e

# Estradiol

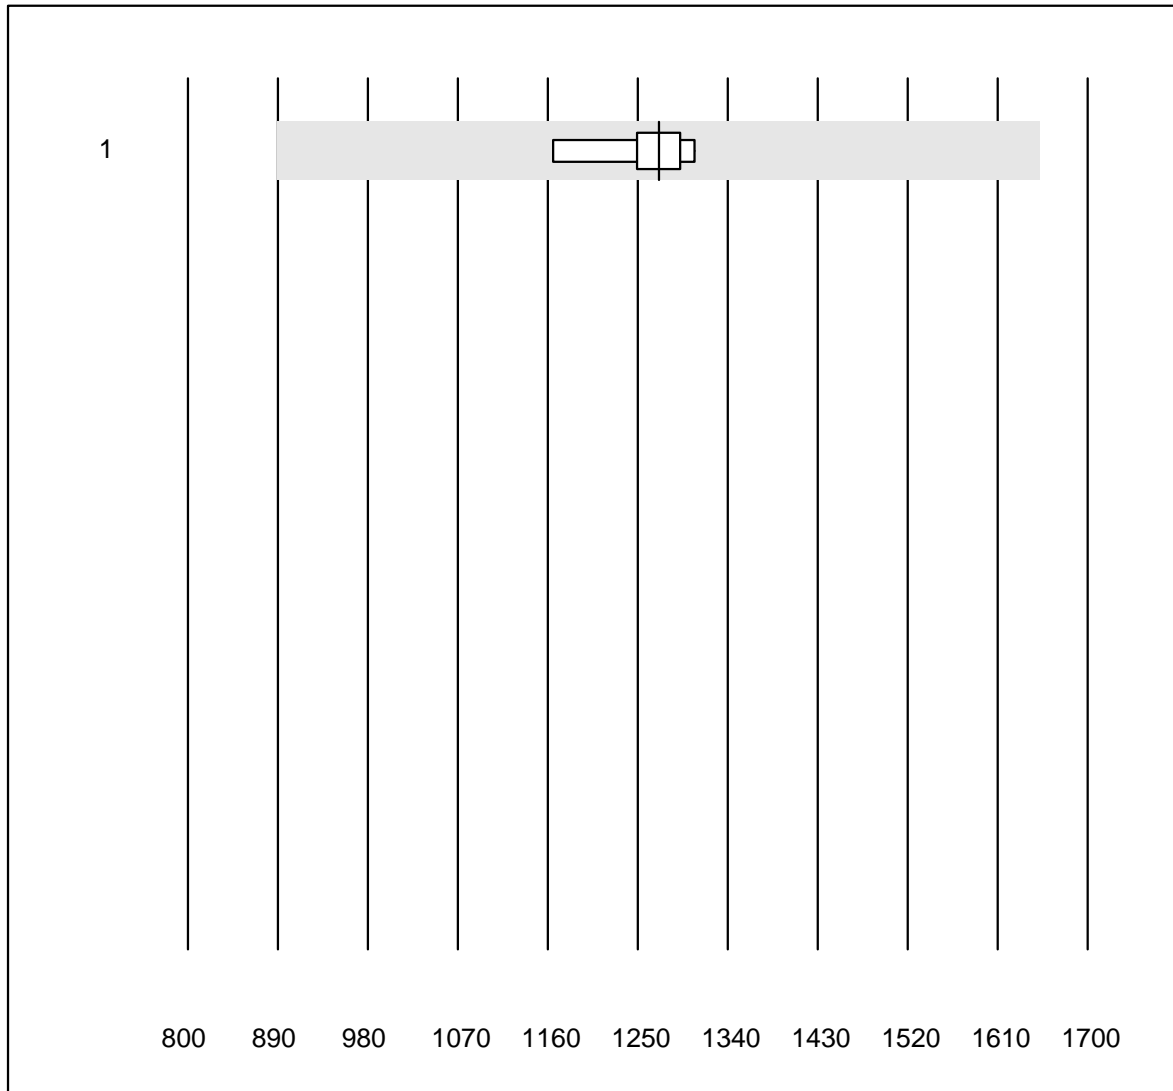


QUALAB Toleranz : 30 %

Estradiol (pmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	6	100.0	0.0	0.0	1271	4.1	e



## SHBG

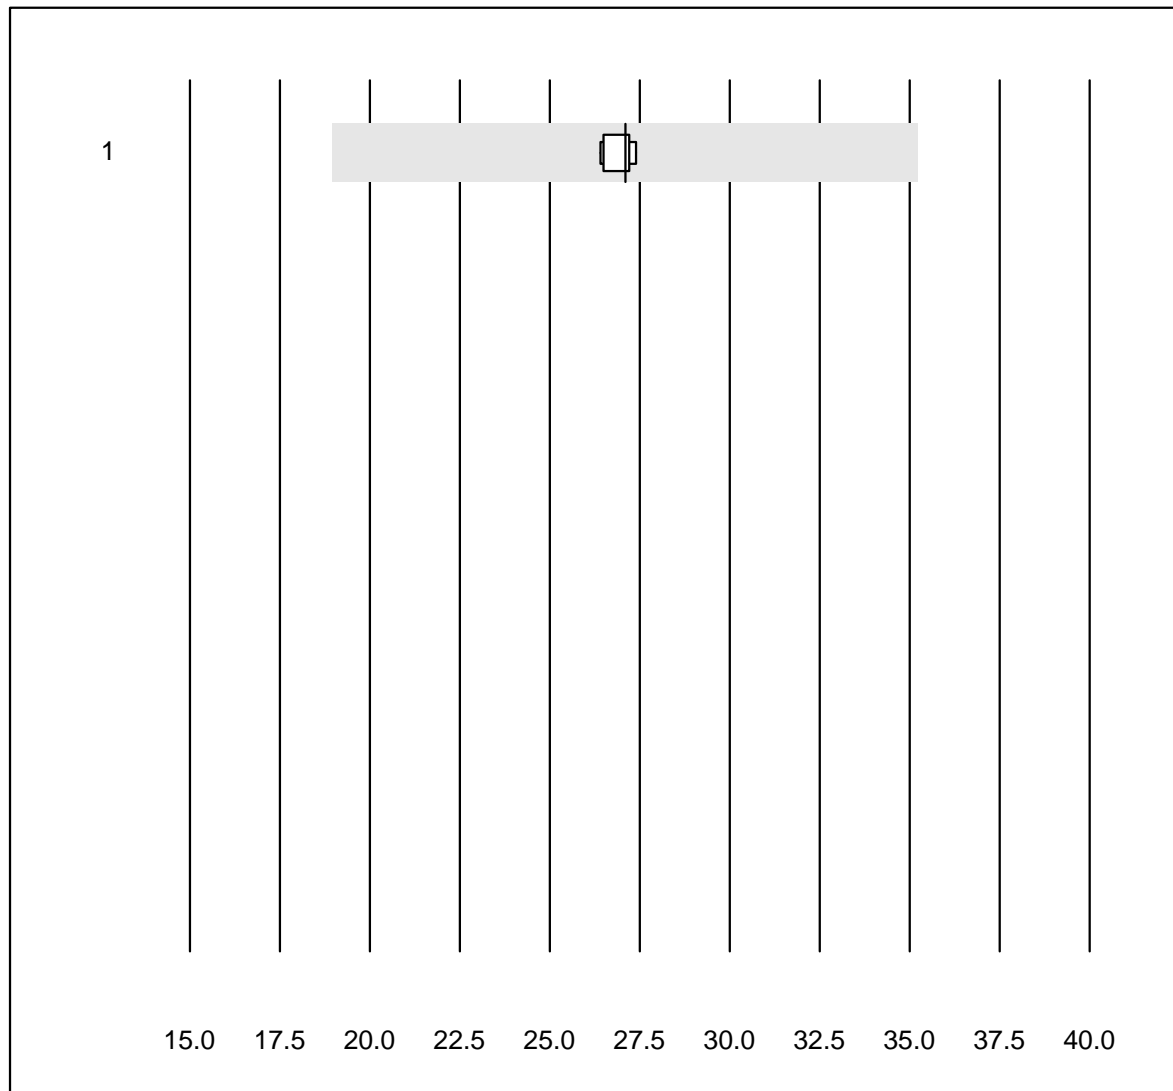


Tolérance MQ : 30 %

SHBG (nmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	27.1	1.6	e

# Cortisol

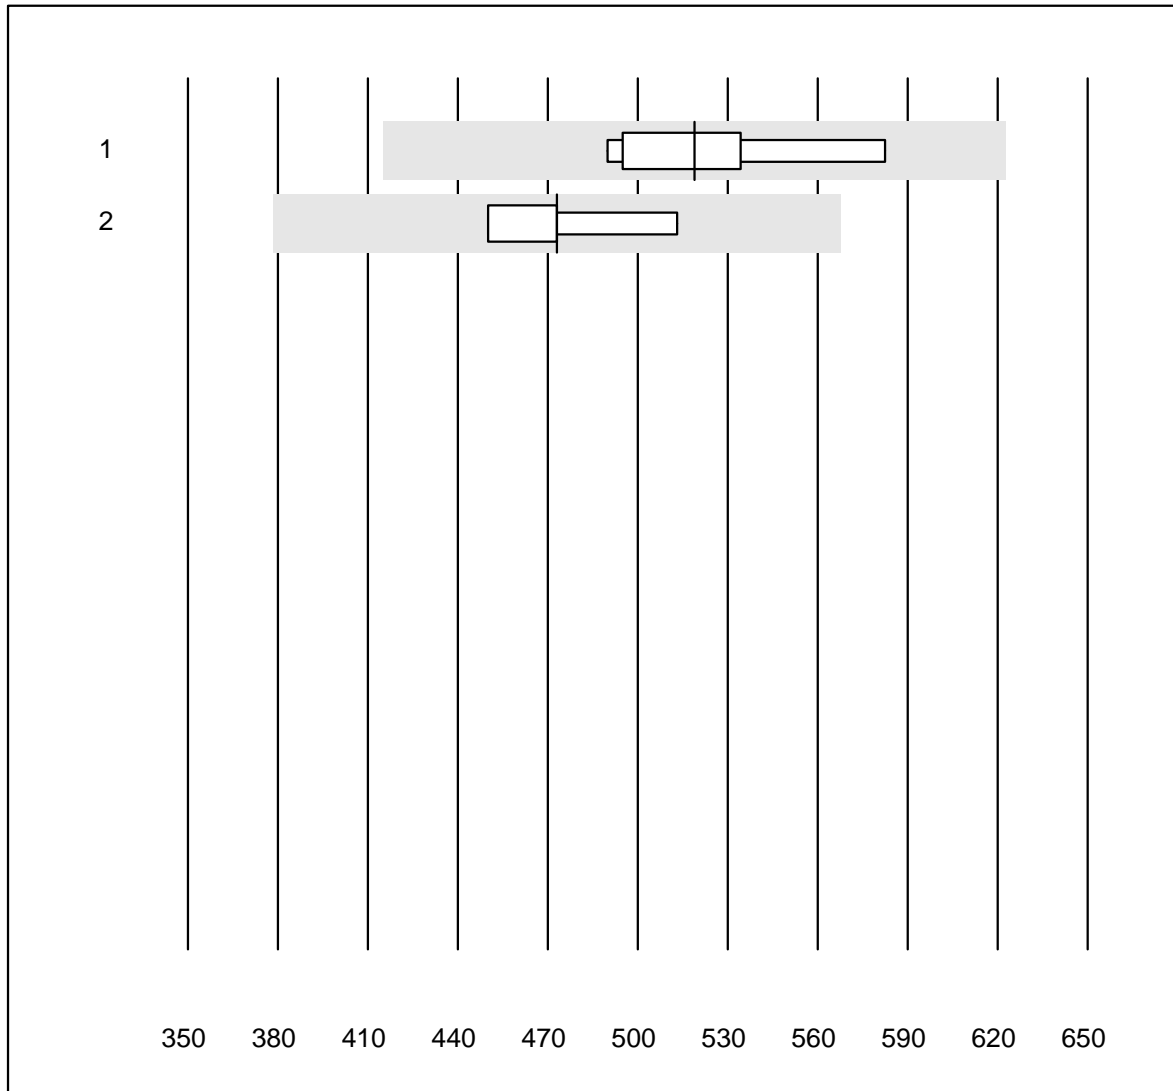


QUALAB Toleranz : 20 %

Cortisol (nmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	8	100.0	0.0	0.0	519	6.8	e
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	473	5.5	e*

# DHEAS

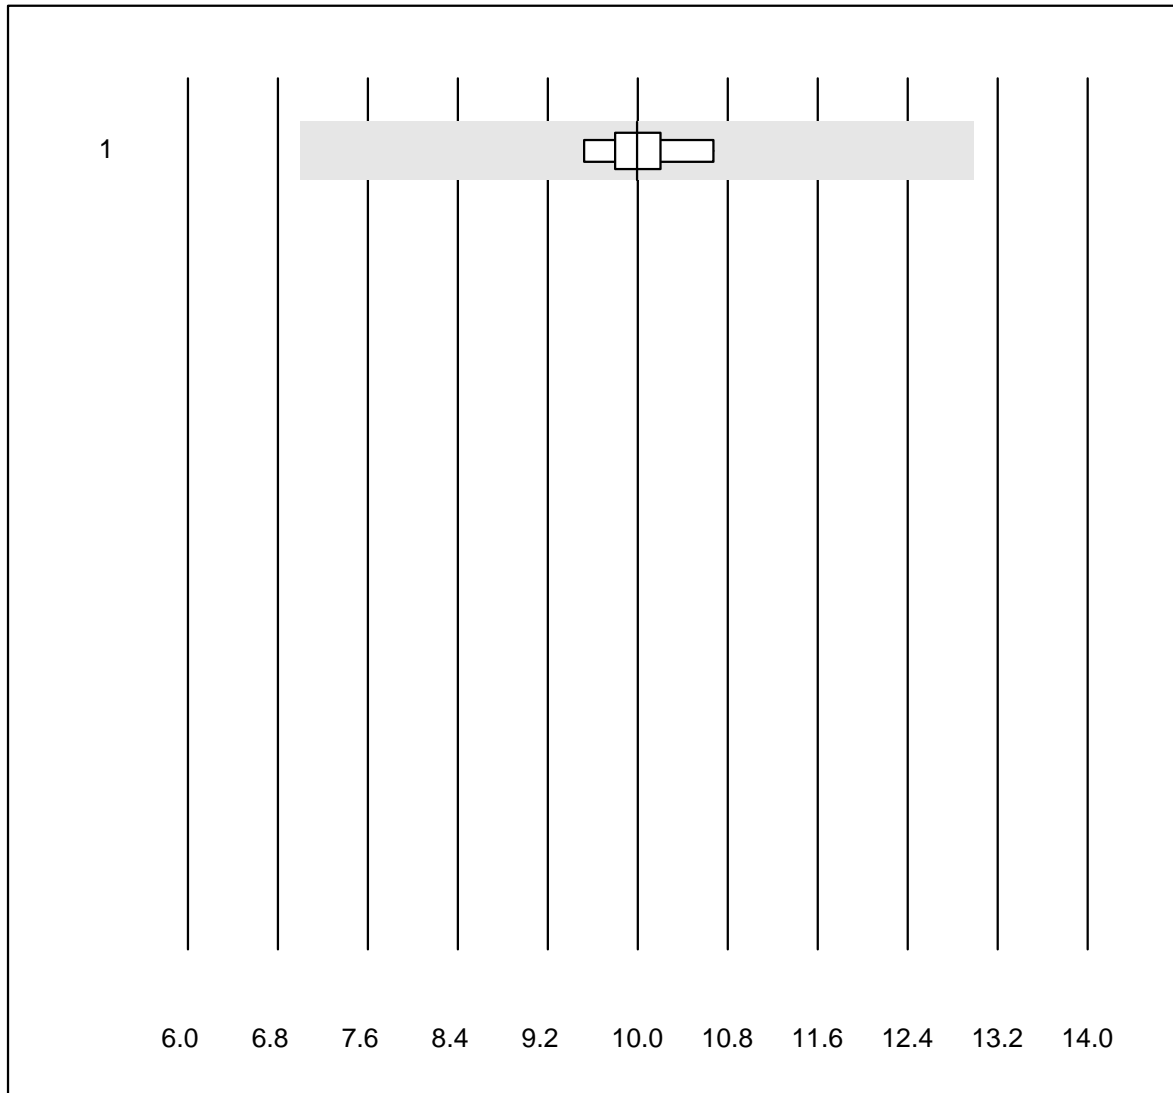


Tolérance MQ : 30 %

DHEAS (µmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	9.99	4.3	e

## Luteinisierendes Hormon

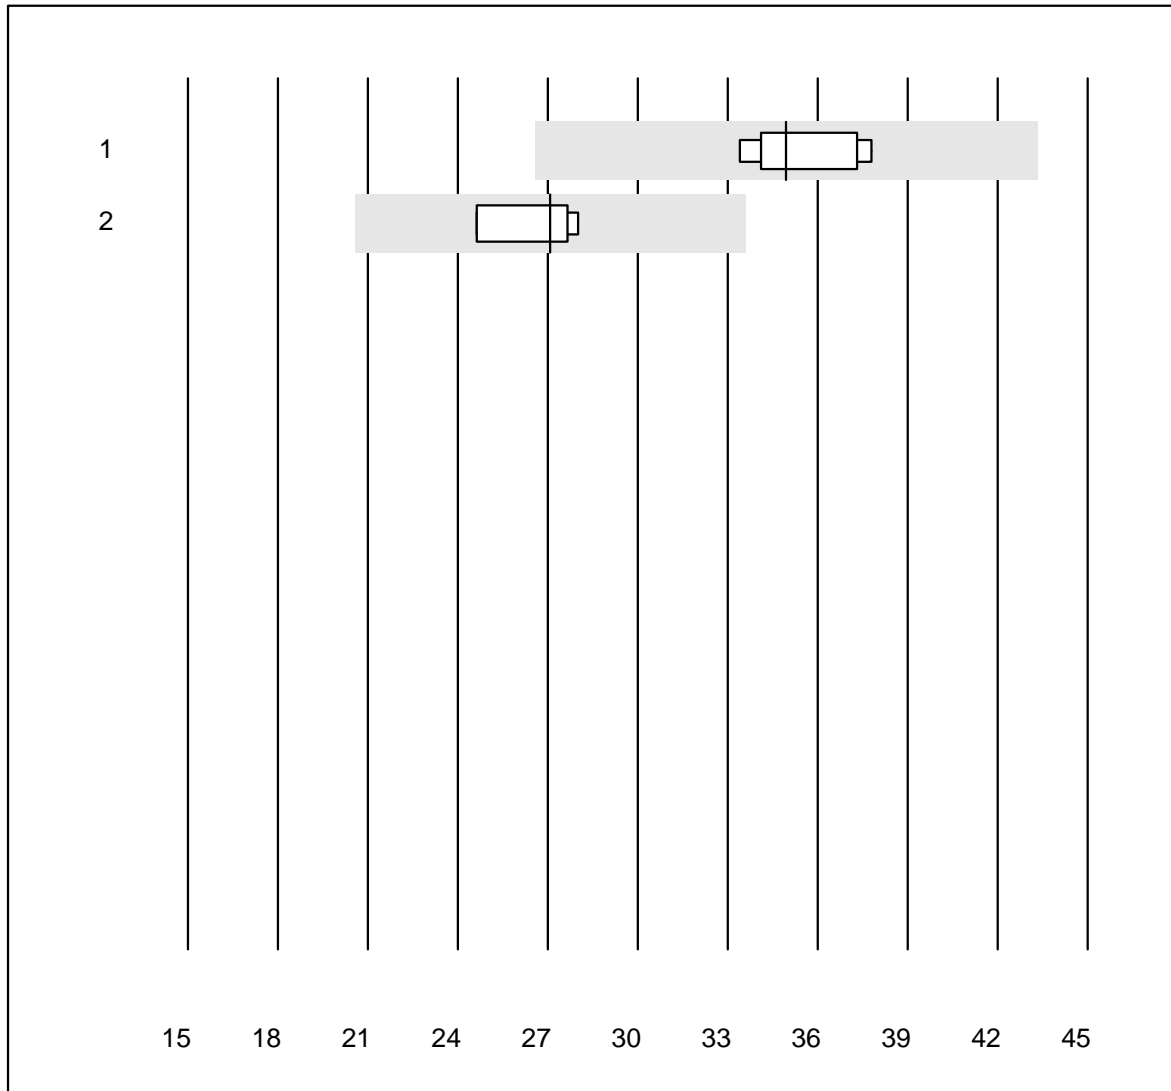


QUALAB Toleranz : 24 %

Luteinisierendes Hormon (U/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Roche, Cobas	7	100.0	0.0	0.0	35.0	4.6	e
2	Architect	4	100.0	0.0	0.0	27.1	5.7	e

## Follikelstimulierendes Hormon

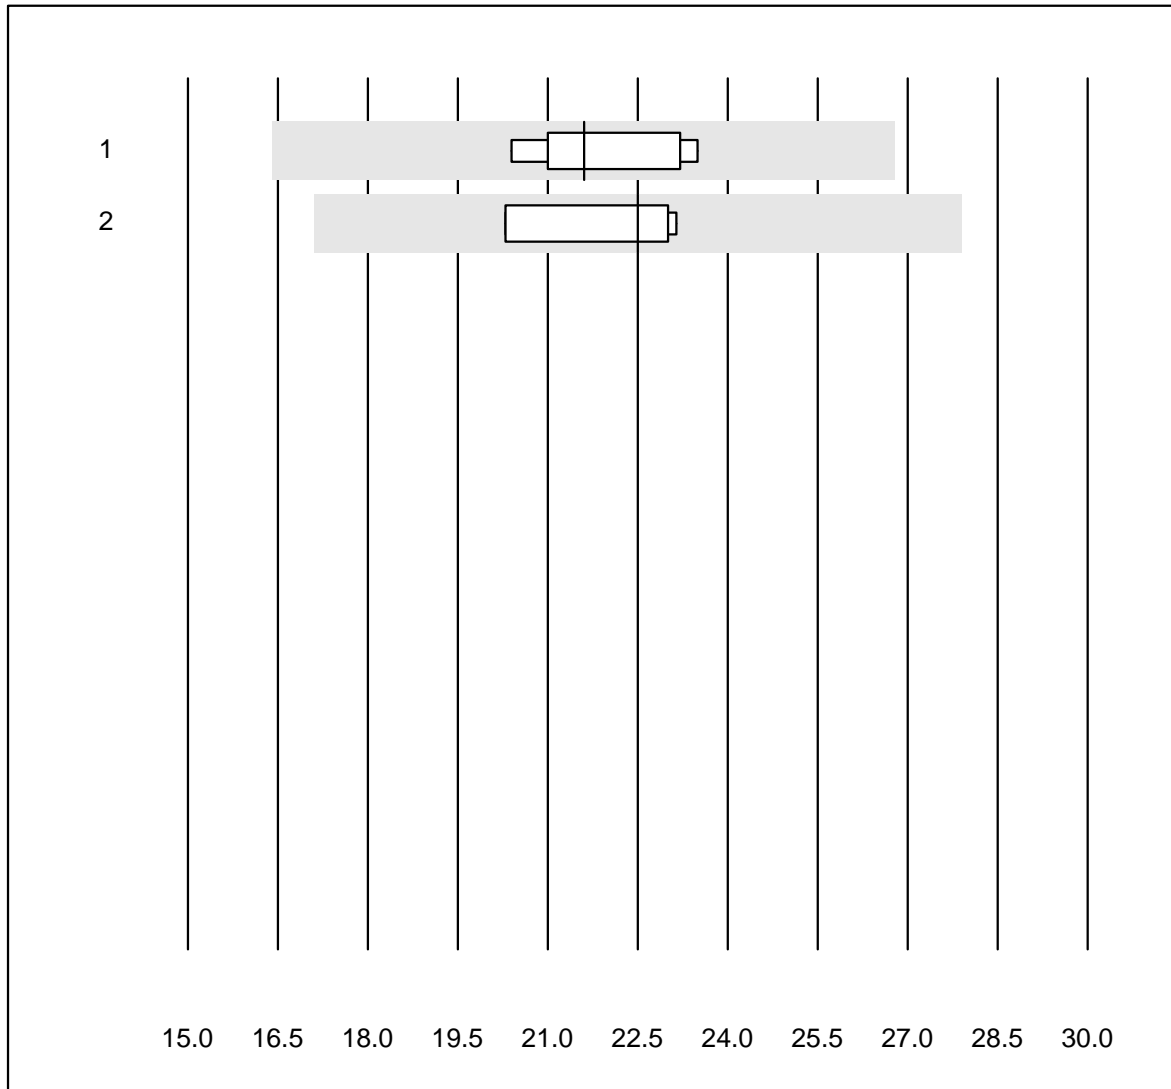


QUALAB Toleranz : 24 %

Follikelstimulierendes Hormon (U/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Roche, Cobas	7	100.0	0.0	0.0	21.6	5.2	e
2	Architect	4	100.0	0.0	0.0	22.5	5.9	e*

## Prolaktin (PRL)

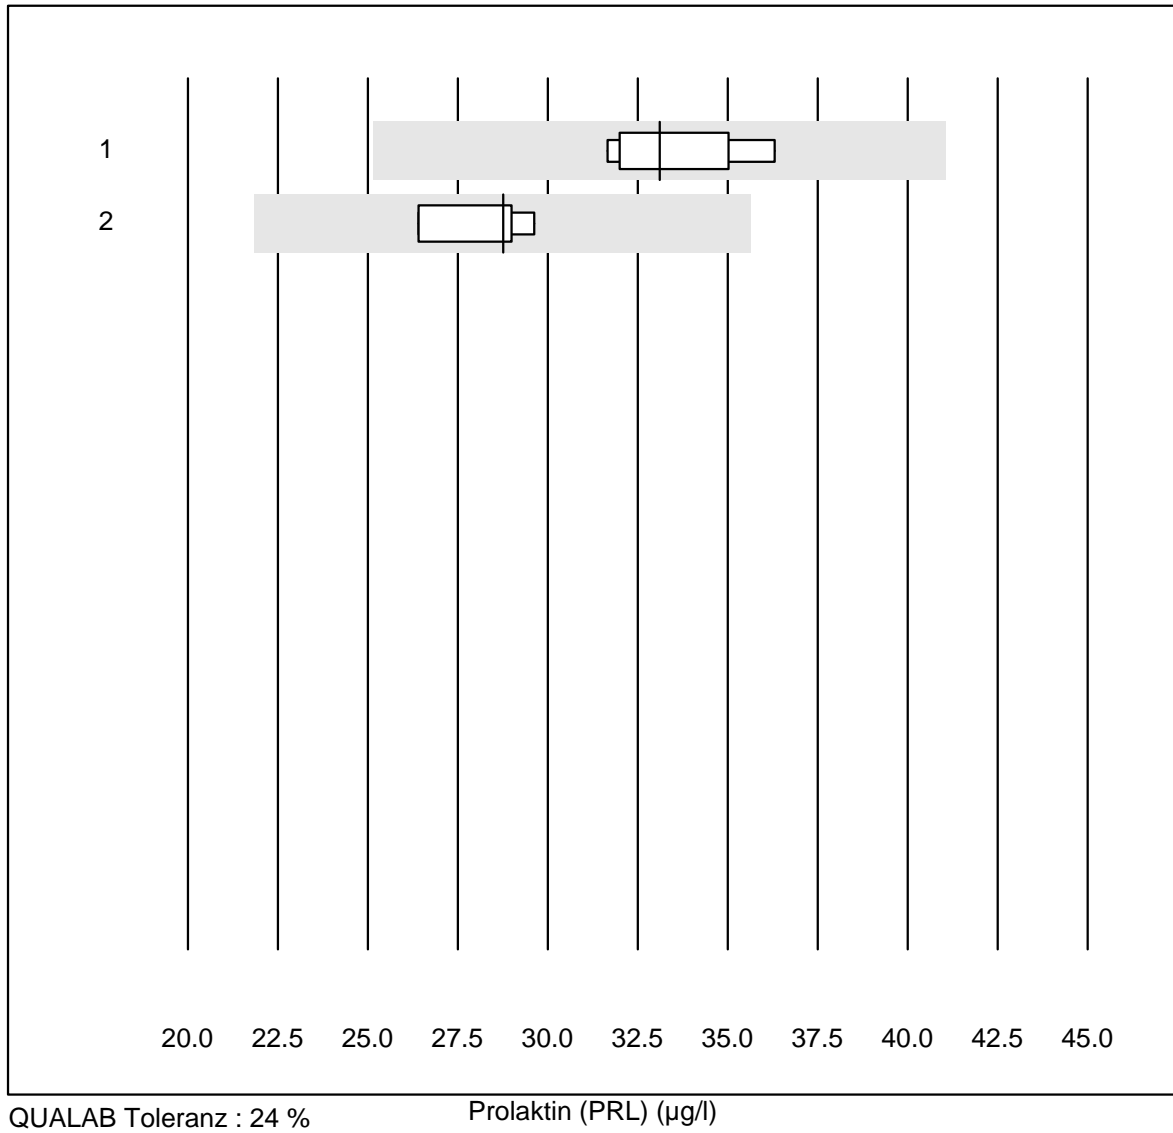

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas/Roche	7	100.0	0.0	0.0	33.1	4.9	e
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	28.8	4.9	e

# HGH

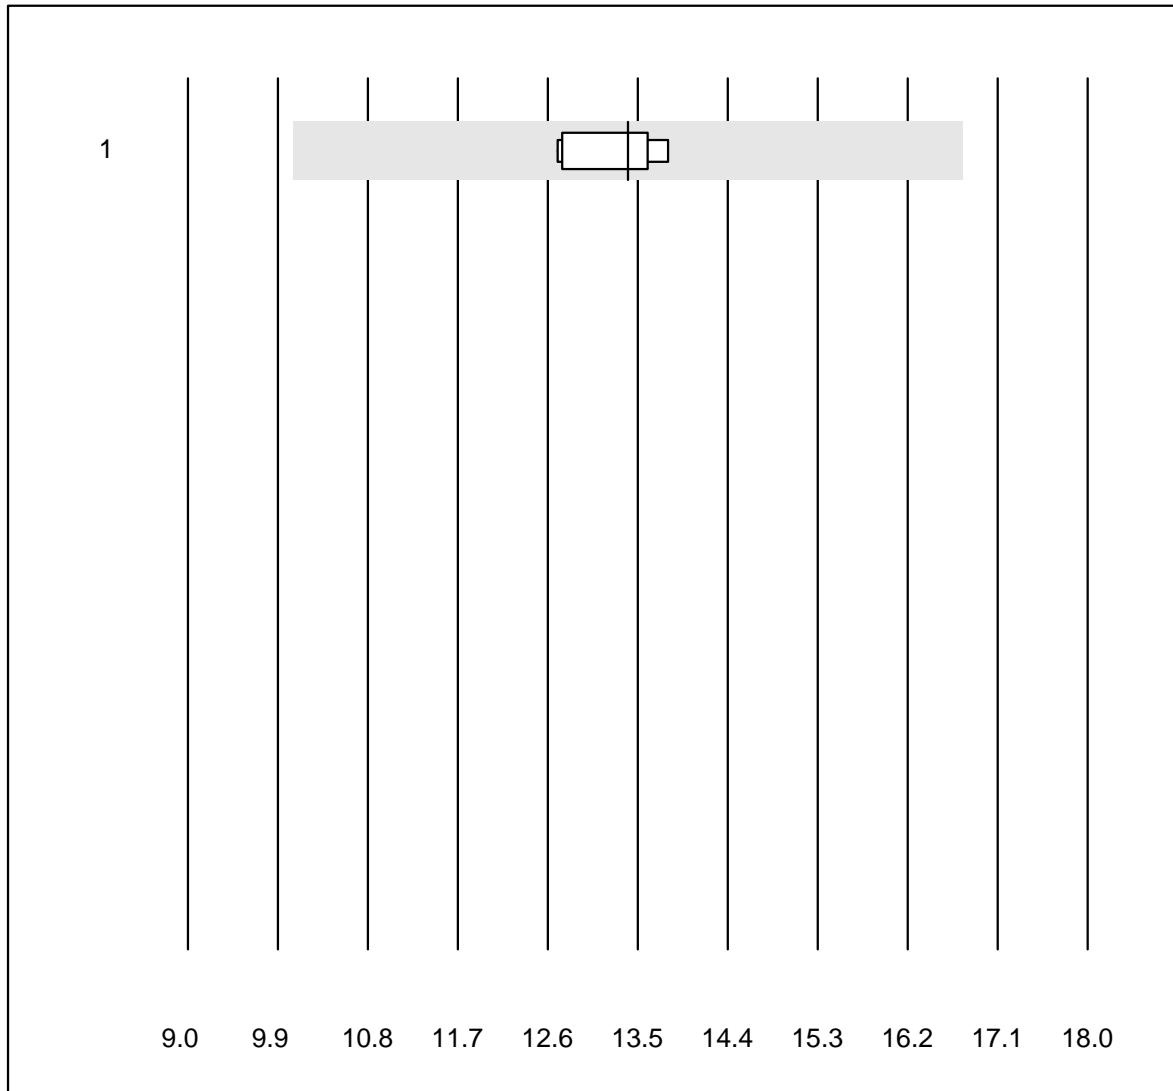


Tolérance MQ : 25 %

HGH (µg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	13.40	3.5	e

# IGF-1

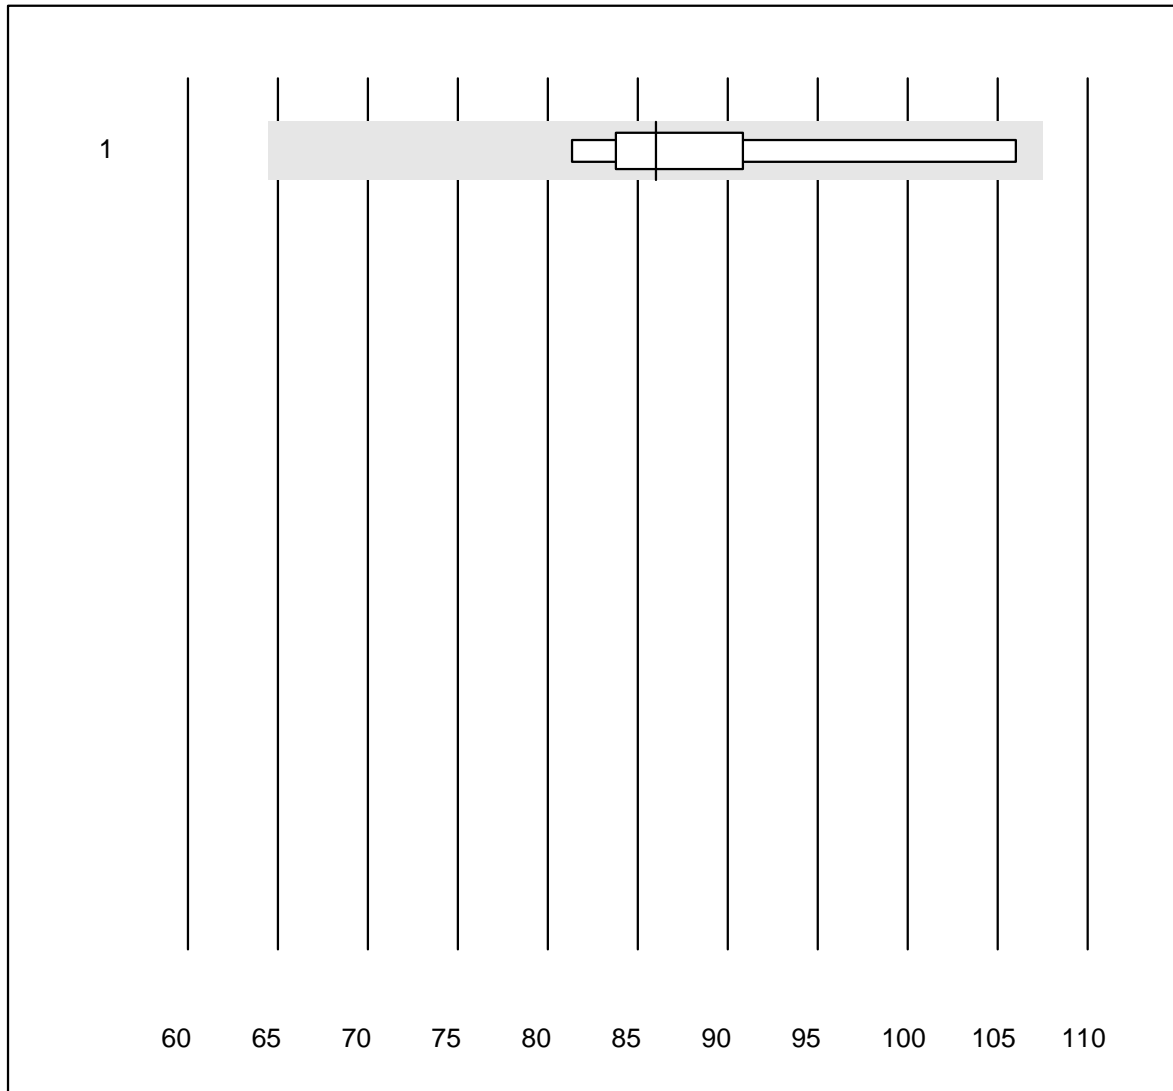


Tolérance MQ : 25 %

IGF-1 (µg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Liaison	5	100.0	0.0	0.0	86	11.0	e*



## Troponine T CR

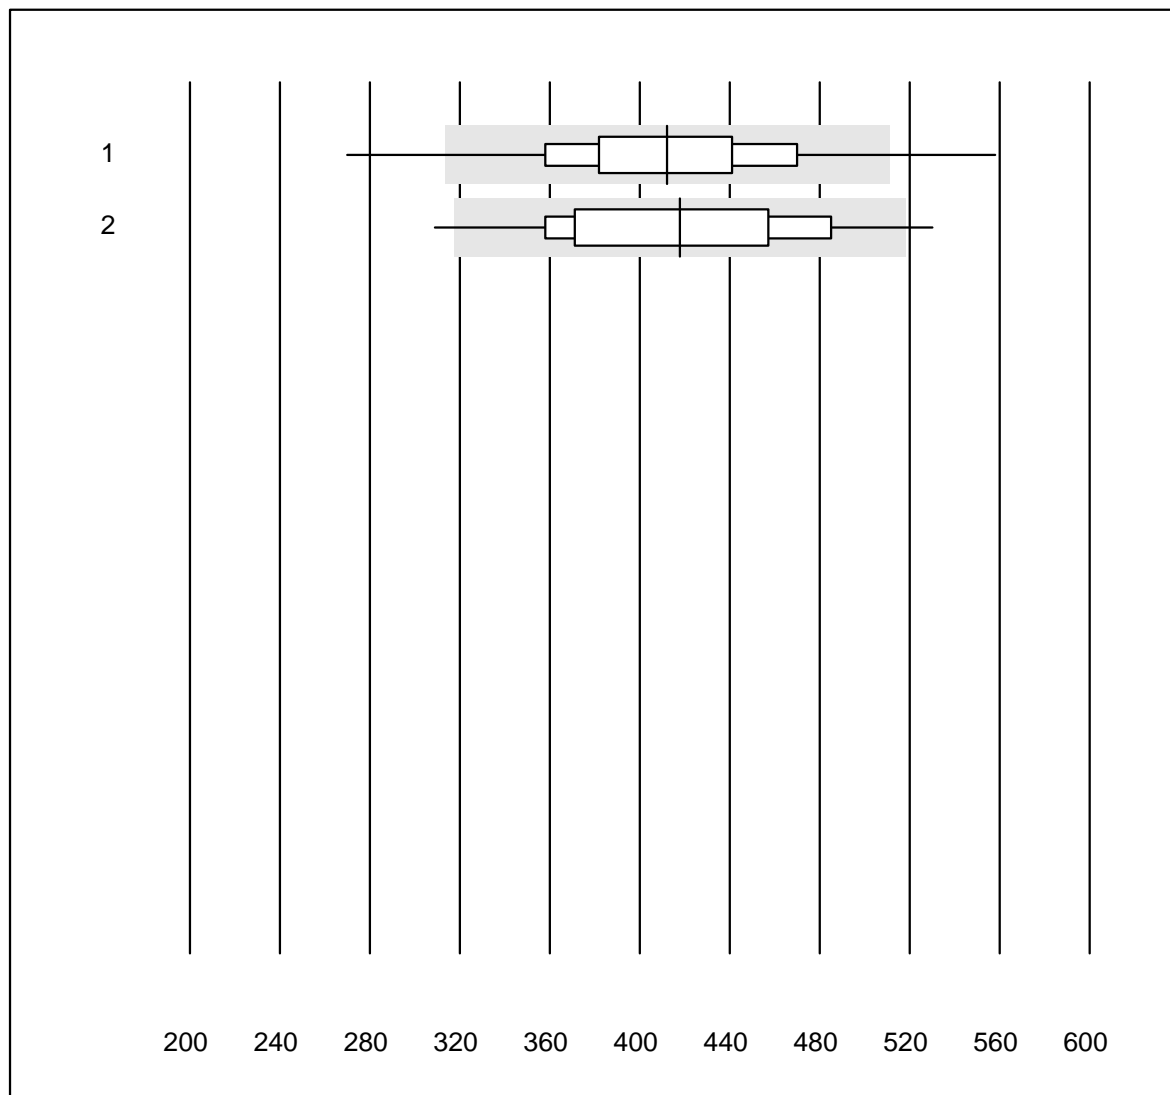


QUALAB Toleranz : 24 %

Troponine T CR (ng/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas h 232	1258	96.5	2.8	0.7	412.05	10.7	e
2 Cardiac Reader	12	83.3	16.7	0.0	417.67	14.5	e*

## D-Dimères CR

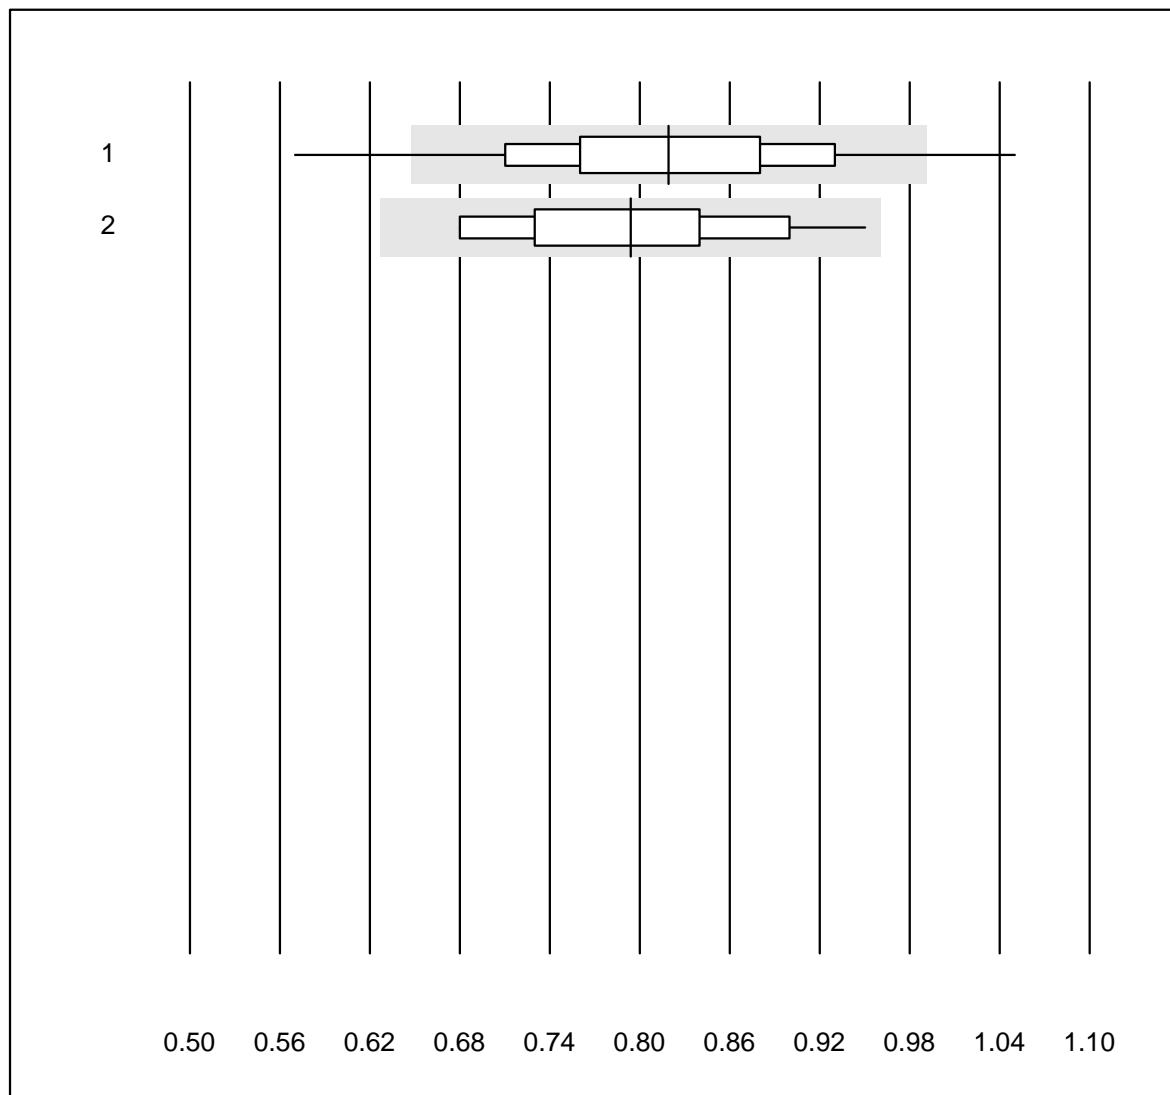


QUALAB Toleranz : 21 %

D-Dimères CR (mg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas h 232	1243	94.0	4.7	1.3	0.82	10.6	e
2	Cardiac Reader	10	100.0	0.0	0.0	0.79	11.1	e*

### CKMB- K8

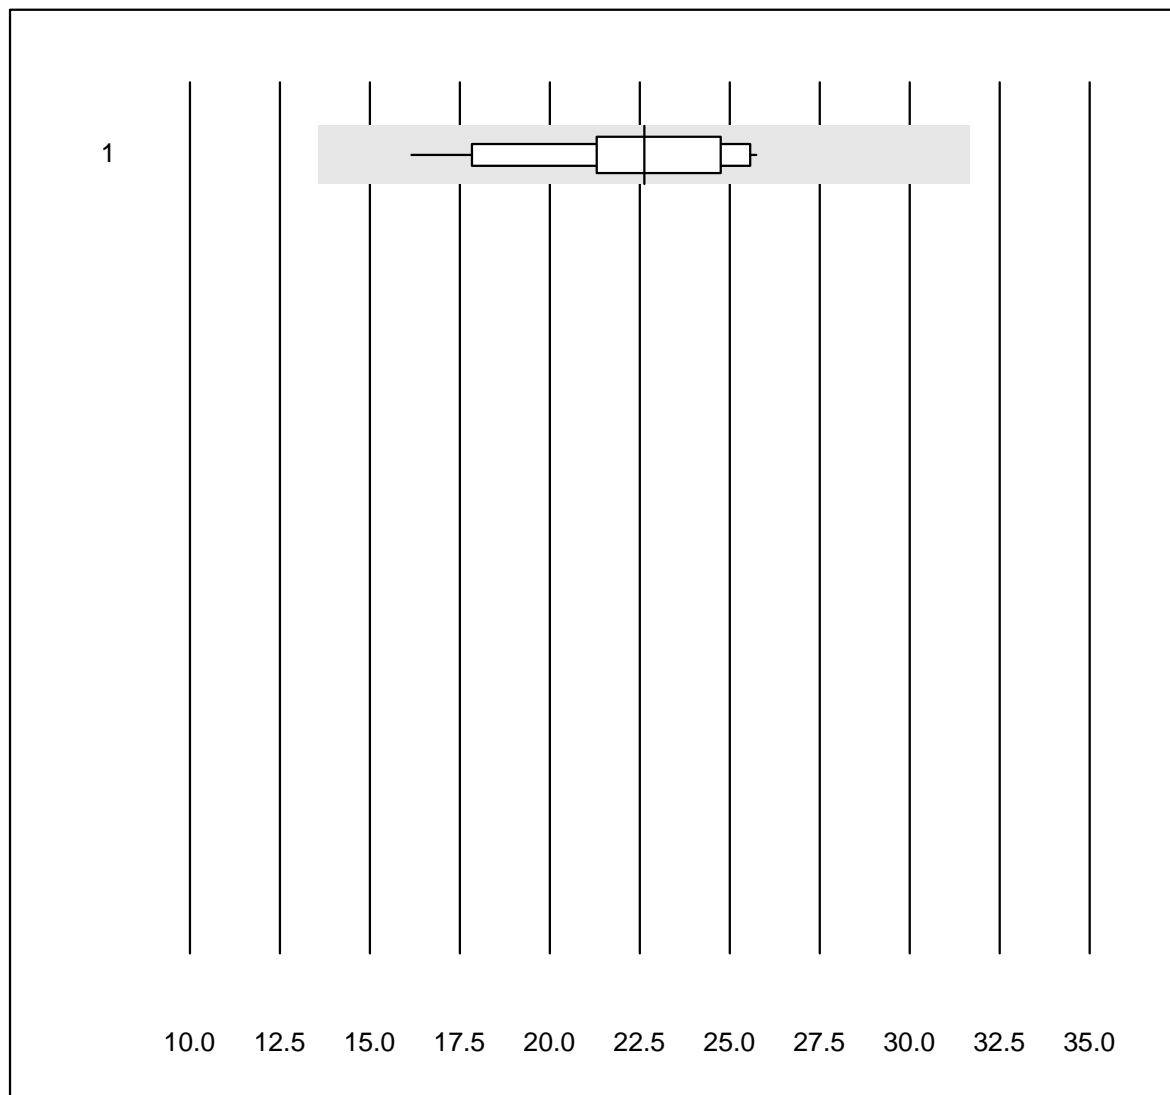


Tolérance MQ : 40 %

CKMB- K8 (µg/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas h 232	12	100.0	0.0	0.0	22.6	13.5	e

## NT-proBNP CR

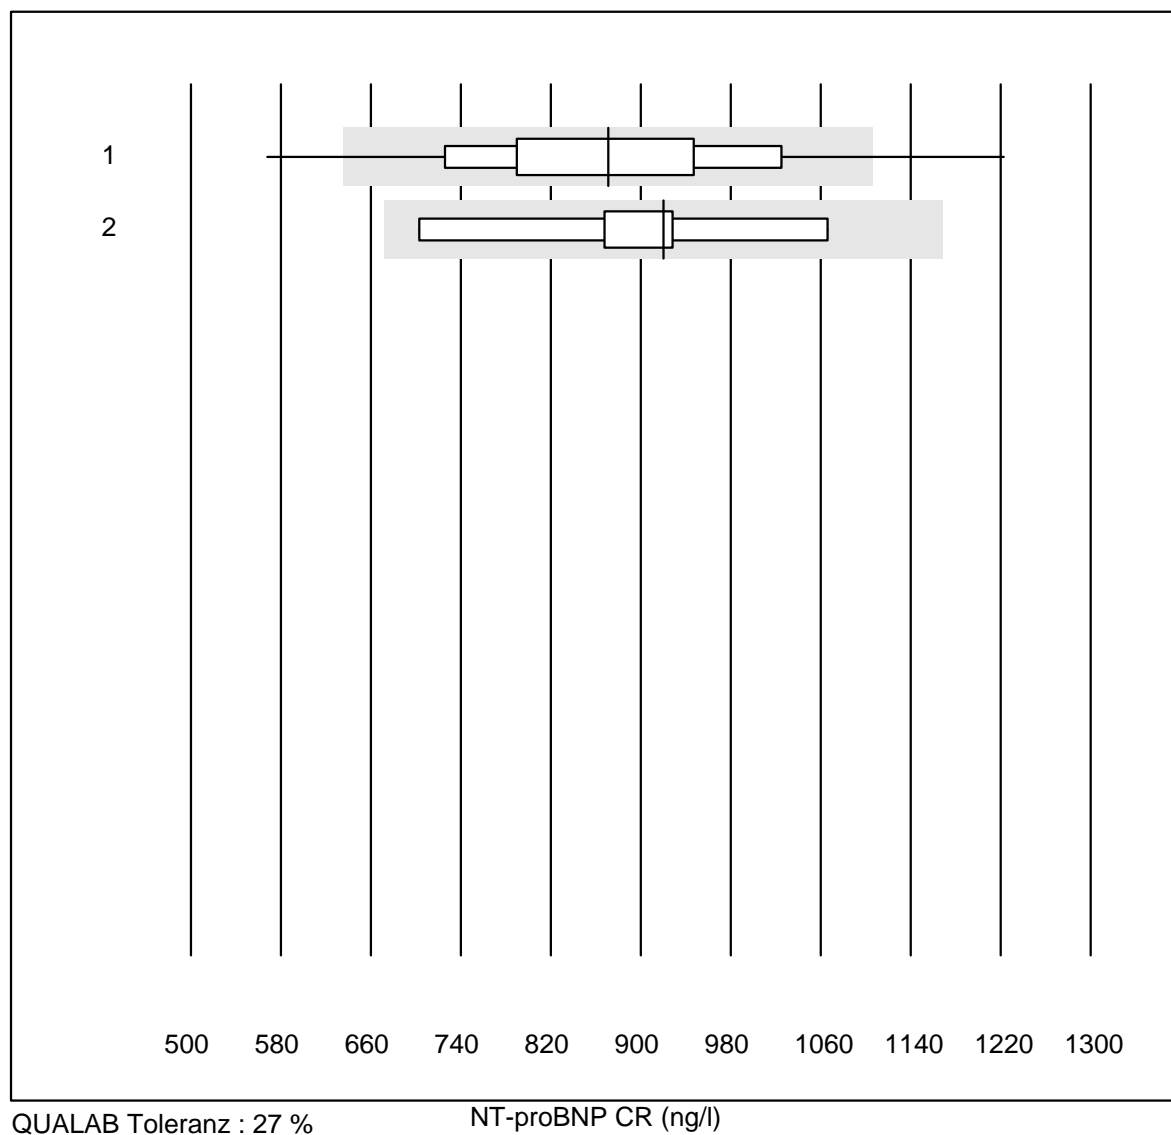

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas h 232	802	94.9	3.9	1.2	871	13.1	e
2	Cardiac Reader	5	100.0	0.0	0.0	920	14.6	e*

## PCO2 CCA

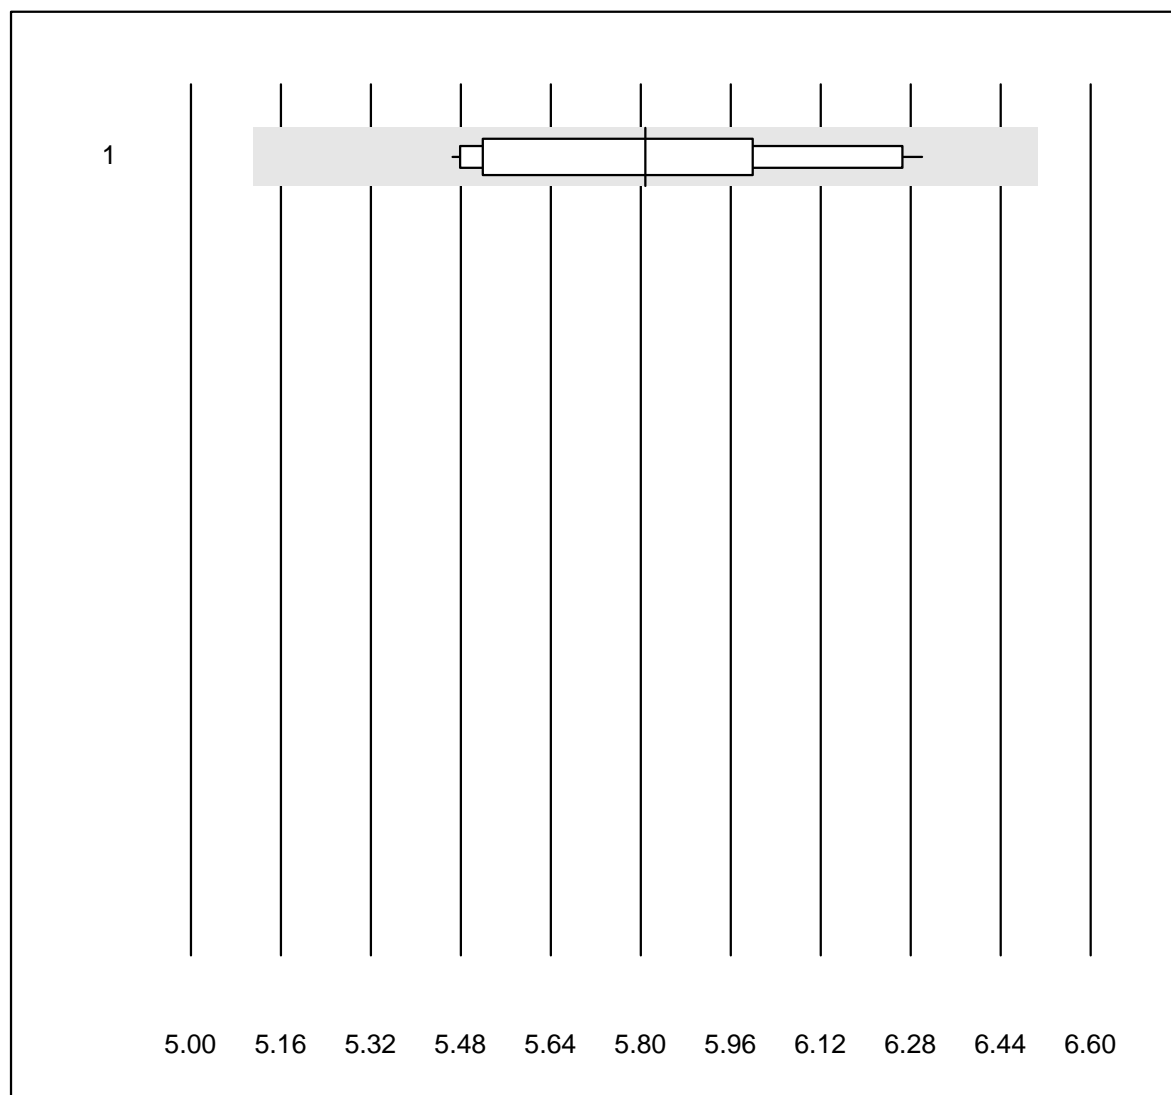


QUALAB Toleranz : 12 %

PCO2 CCA (kPa)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 OPTI CCA	11	100.0	0.0	0.0	5.81	5.0	e*

## PO2 CCA

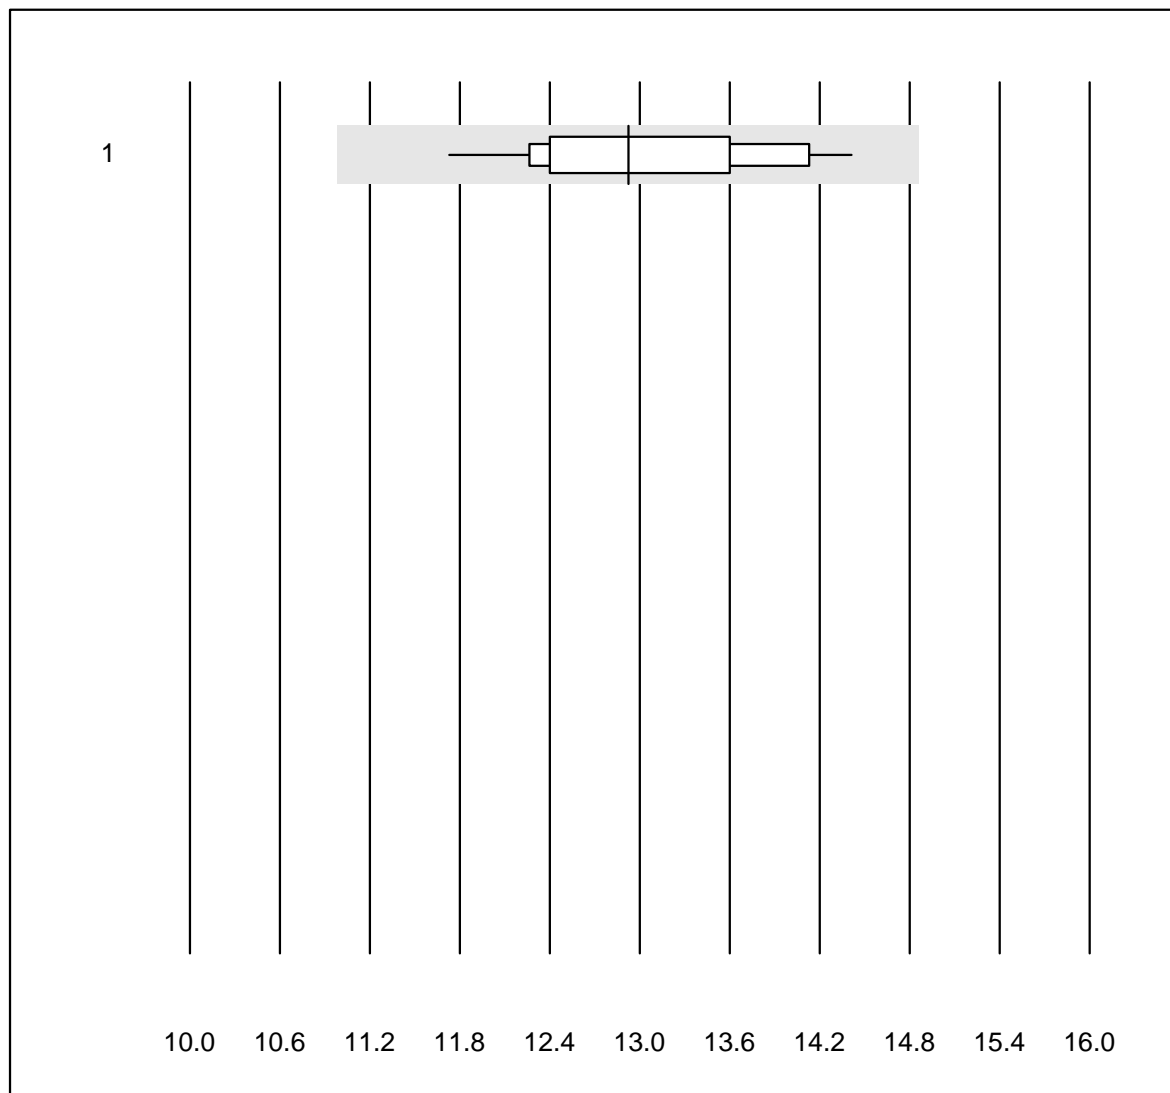


QUALAB Toleranz : 15 %

PO2 CCA (kPa)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 OPTI CCA	11	100.0	0.0	0.0	12.92	6.7	e*

## pH CCA

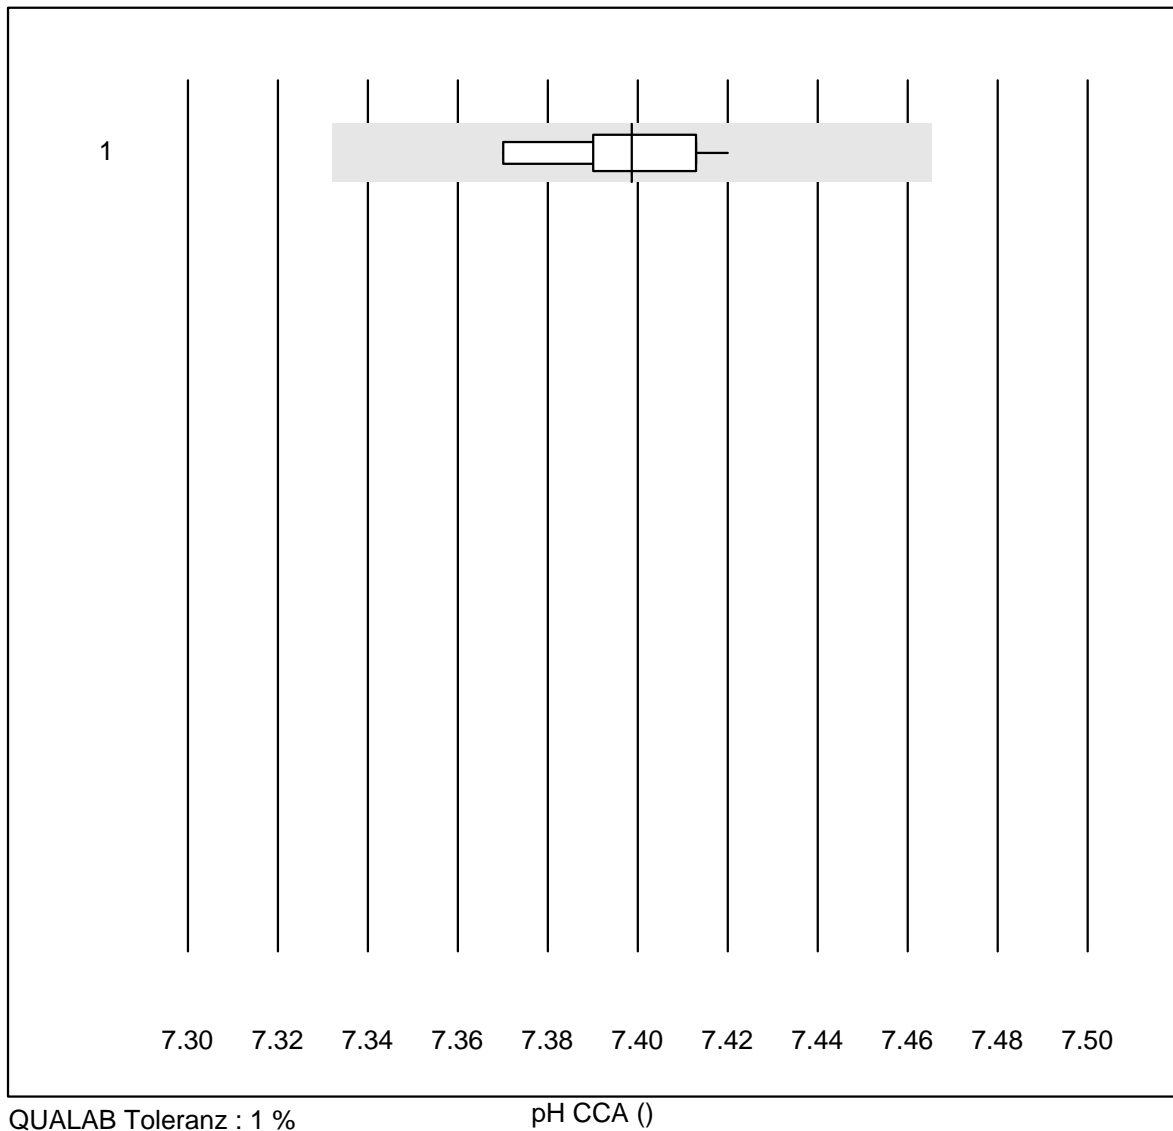

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	OPTI CCA	10	100.0	0.0	0.0	7.40	0.2	e

## Potassium CCA

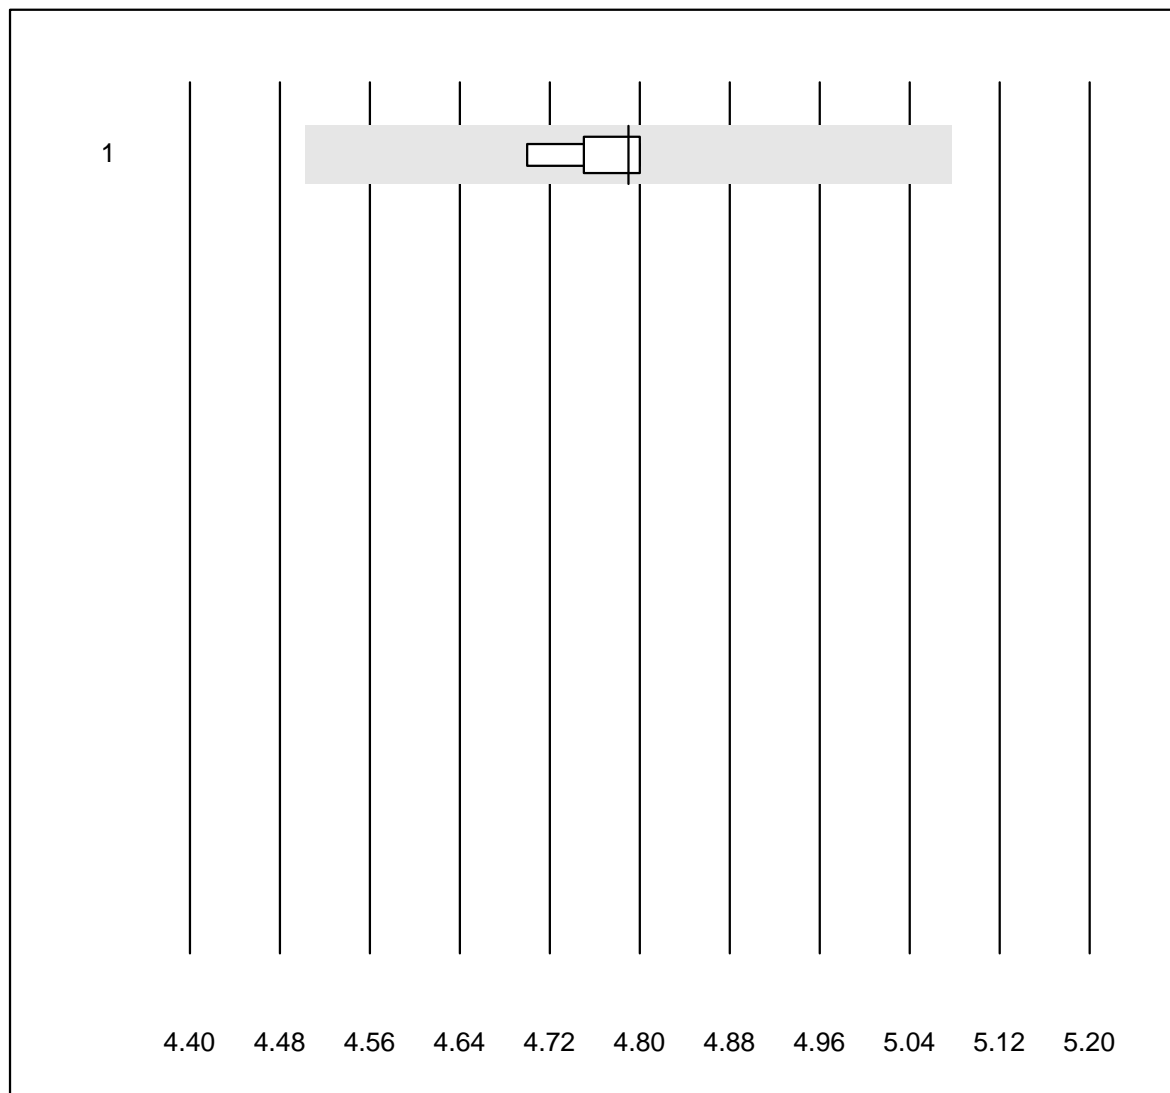


QUALAB Toleranz : 6 %

Potassium CCA (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	OPTI CCA	5	100.0	0.0	0.0	4.8	0.9	e



## Sodium CCA

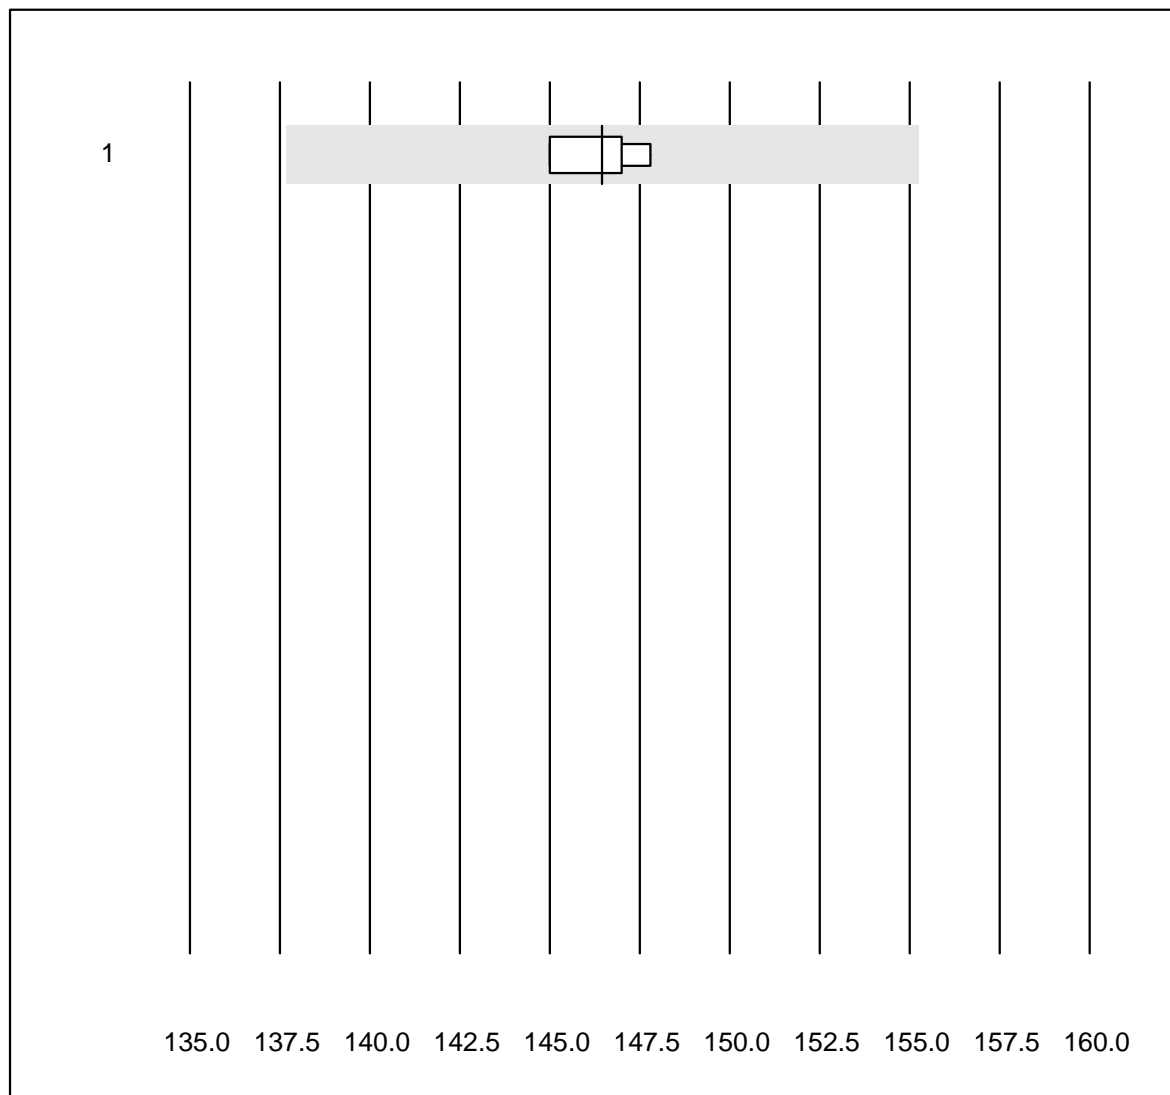


QUALAB Toleranz : 6 %

Sodium CCA (mmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	OPTI CCA	4	100.0	0.0	0.0	146.5	0.8	e

## Ferritine

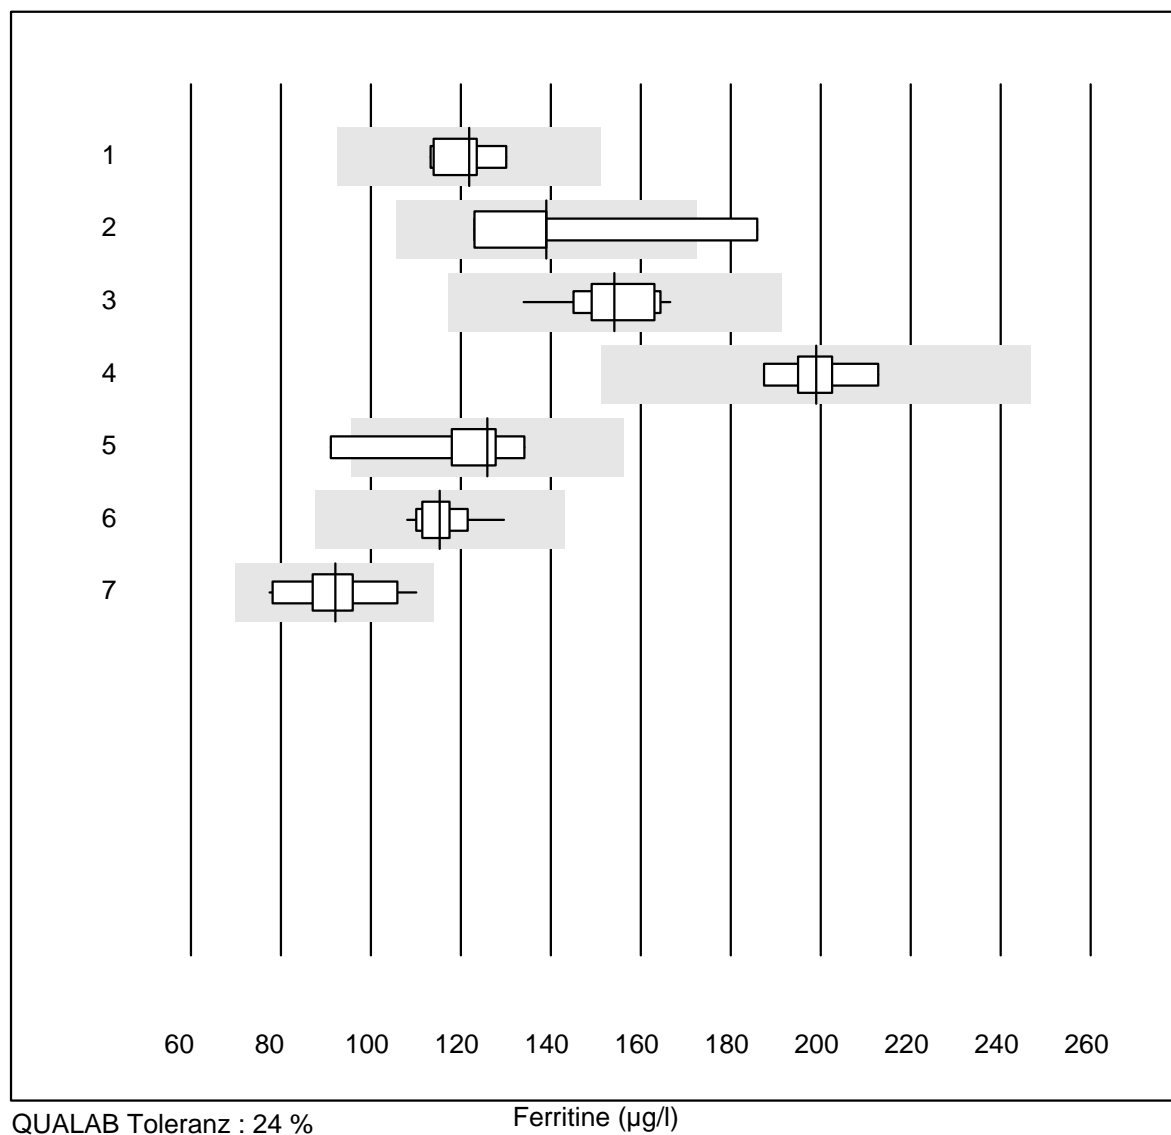

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Beckman	8	100.0	0.0	0.0	121.90	4.5	e
2	toutes les méthodes	5	60.0	20.0	20.0	139.00	20.3	e*
3	Cobas E / Elecsys	15	100.0	0.0	0.0	154.18	5.8	e
4	Architect	9	100.0	0.0	0.0	199.00	3.8	e
5	Mini Vidas	9	88.9	11.1	0.0	125.90	10.7	e*
6	AFIAS	47	100.0	0.0	0.0	115.28	4.2	e
7	Eurolyser	19	100.0	0.0	0.0	92.06	8.8	e

## Vitamine B12

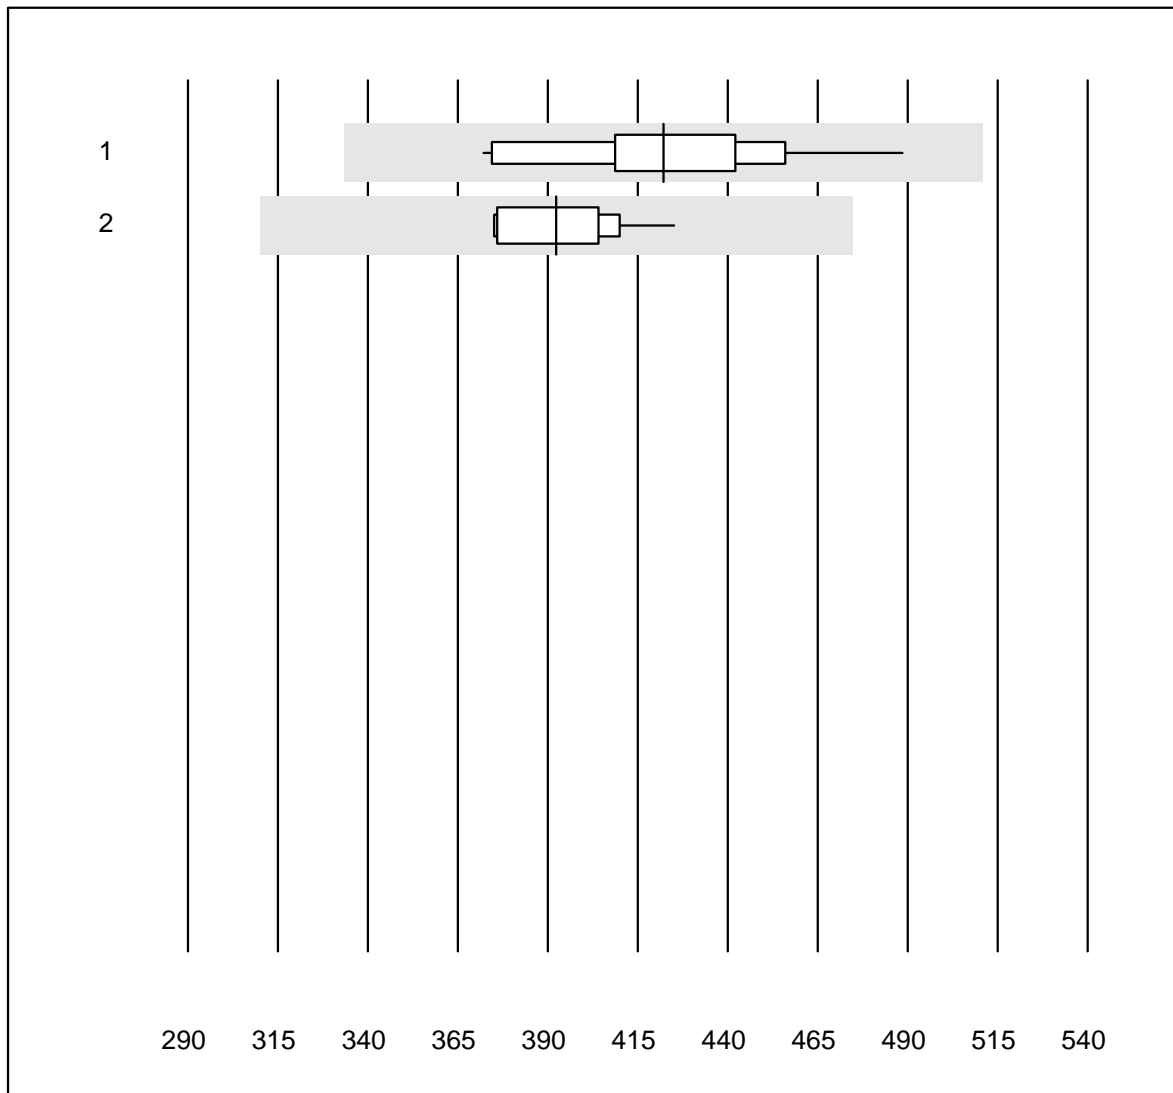


QUALAB Toleranz : 21 %

Vitamine B12 (pmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	14	100.0	0.0	0.0	422.22	7.6	e
2	Architect	10	100.0	0.0	0.0	392.28	4.2	e

## Folate

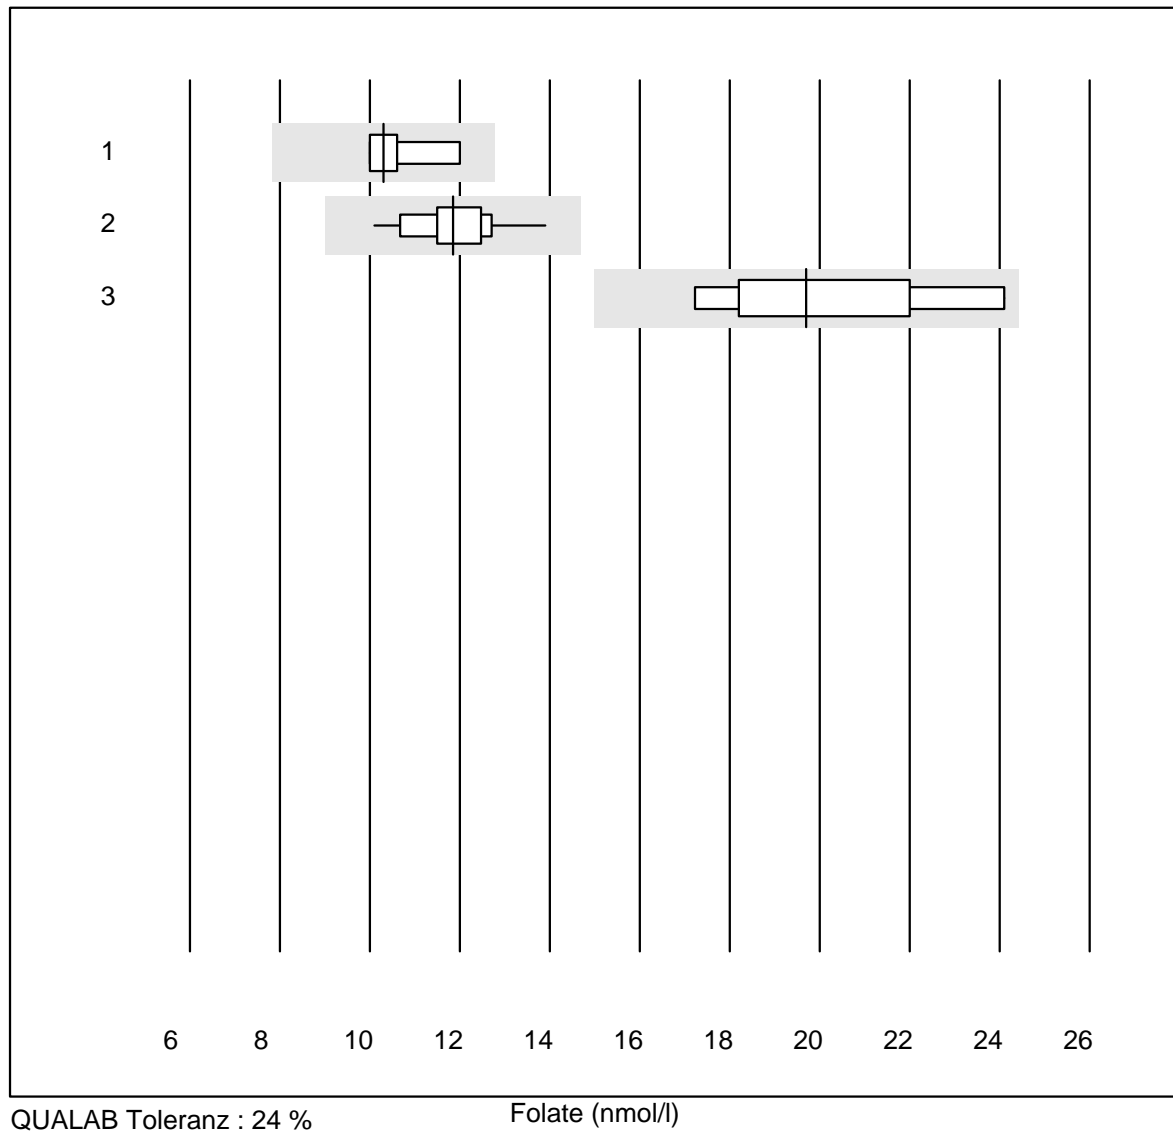


QUALAB Toleranz : 24 %

Folate (nmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	10.30	8.9	e*
2 Cobas E / Elecsys	13	100.0	0.0	0.0	11.85	8.2	e
3 Architect	9	100.0	0.0	0.0	19.70	12.1	e*

## Holotranscobalamine

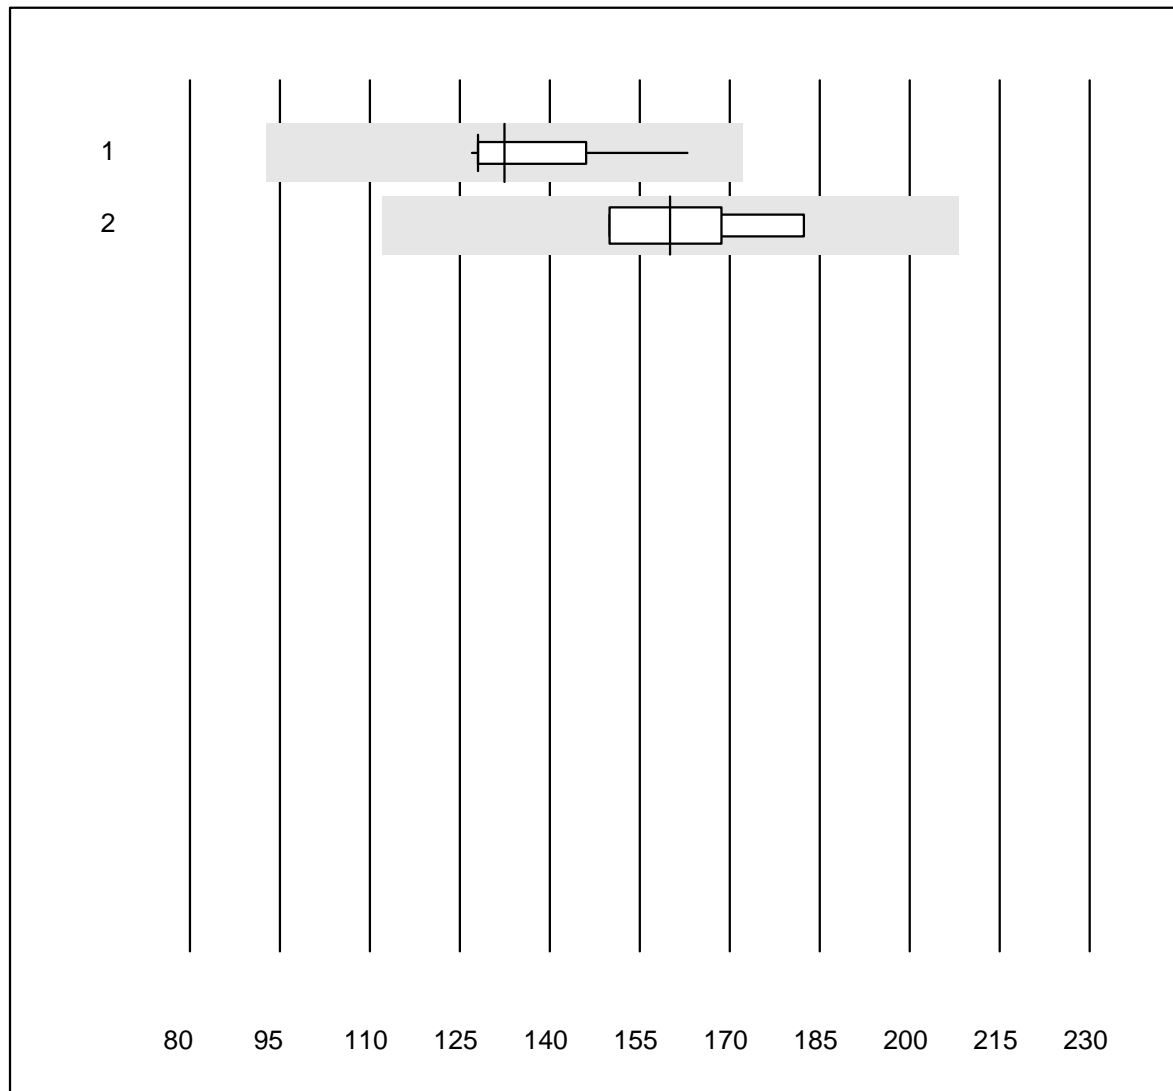


Tolérance MQ : 30 %

Holotranscobalamine (pmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Efulft	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Architect	15	100.0	0.0	0.0	132.5	7.7	e
2	toutes les méthodes	11	81.8	0.0	18.2	160.0	8.2	e

## Bilirubin totale Neo

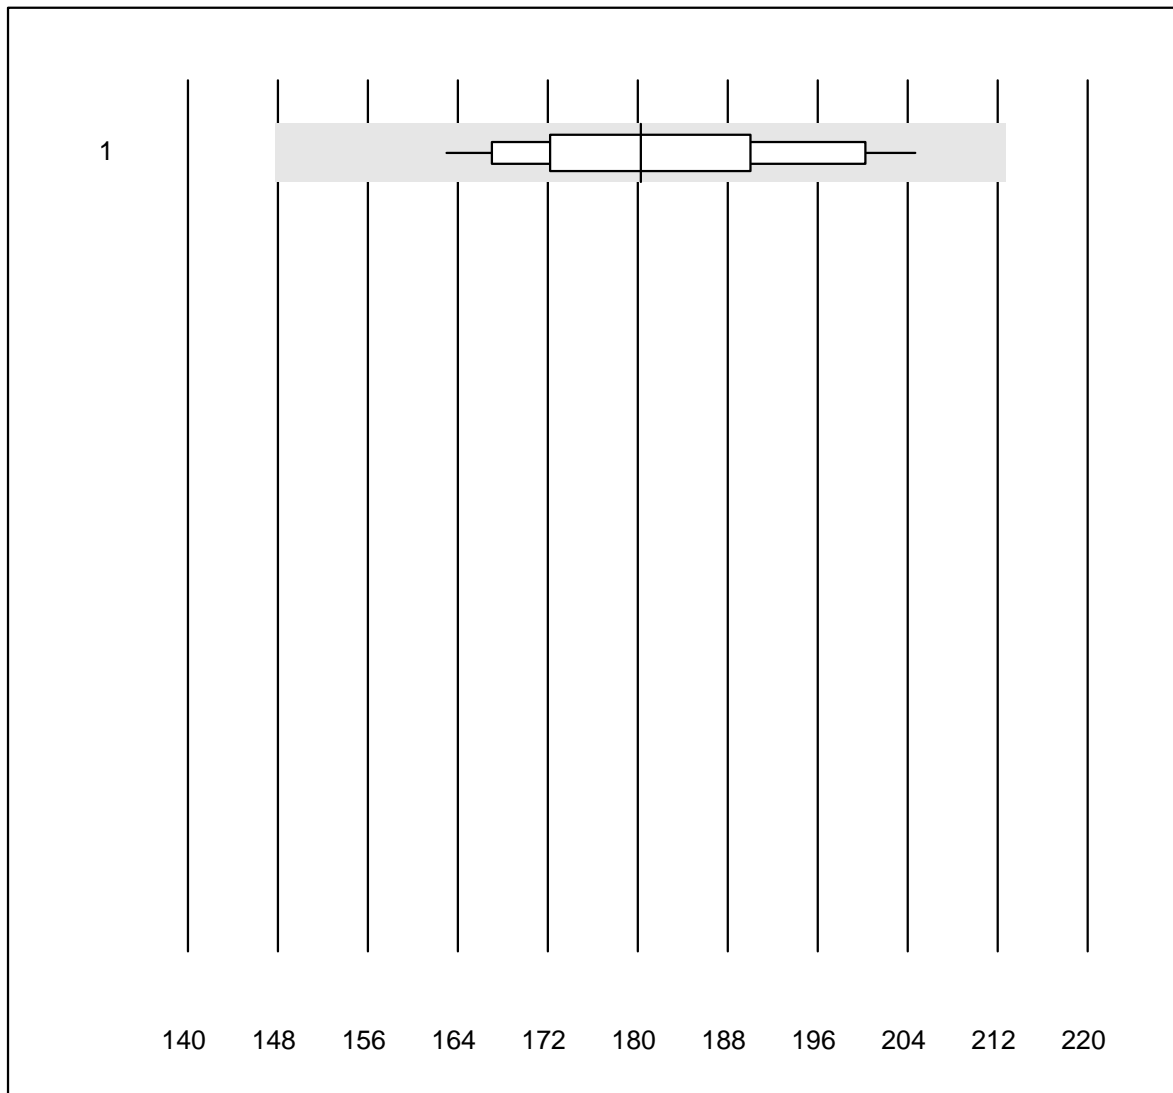


QUALAB Toleranz : 18 %

Bilirubin totale Neo (µmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	17	100.0	0.0	0.0	180	6.9	e

## Bilirubin directe

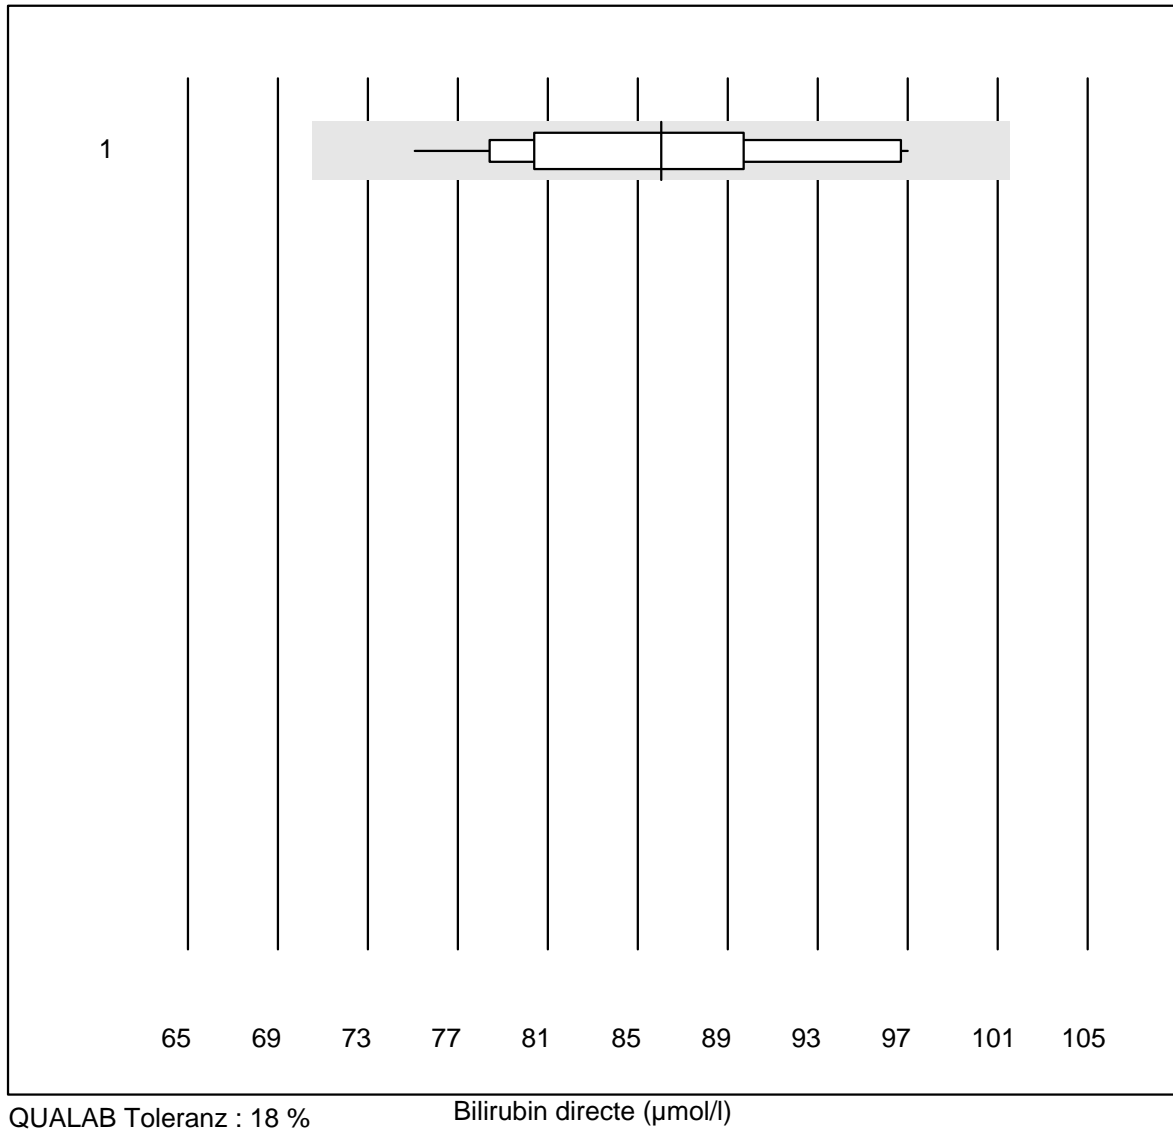

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	16	100.0	0.0	0.0	86	7.5	e


## Bilirubin néonatale



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	9	100.0	0.0	0.0	236	2.5	e
2 ABL700/800	8	100.0	0.0	0.0	212	4.0	e



# PSA

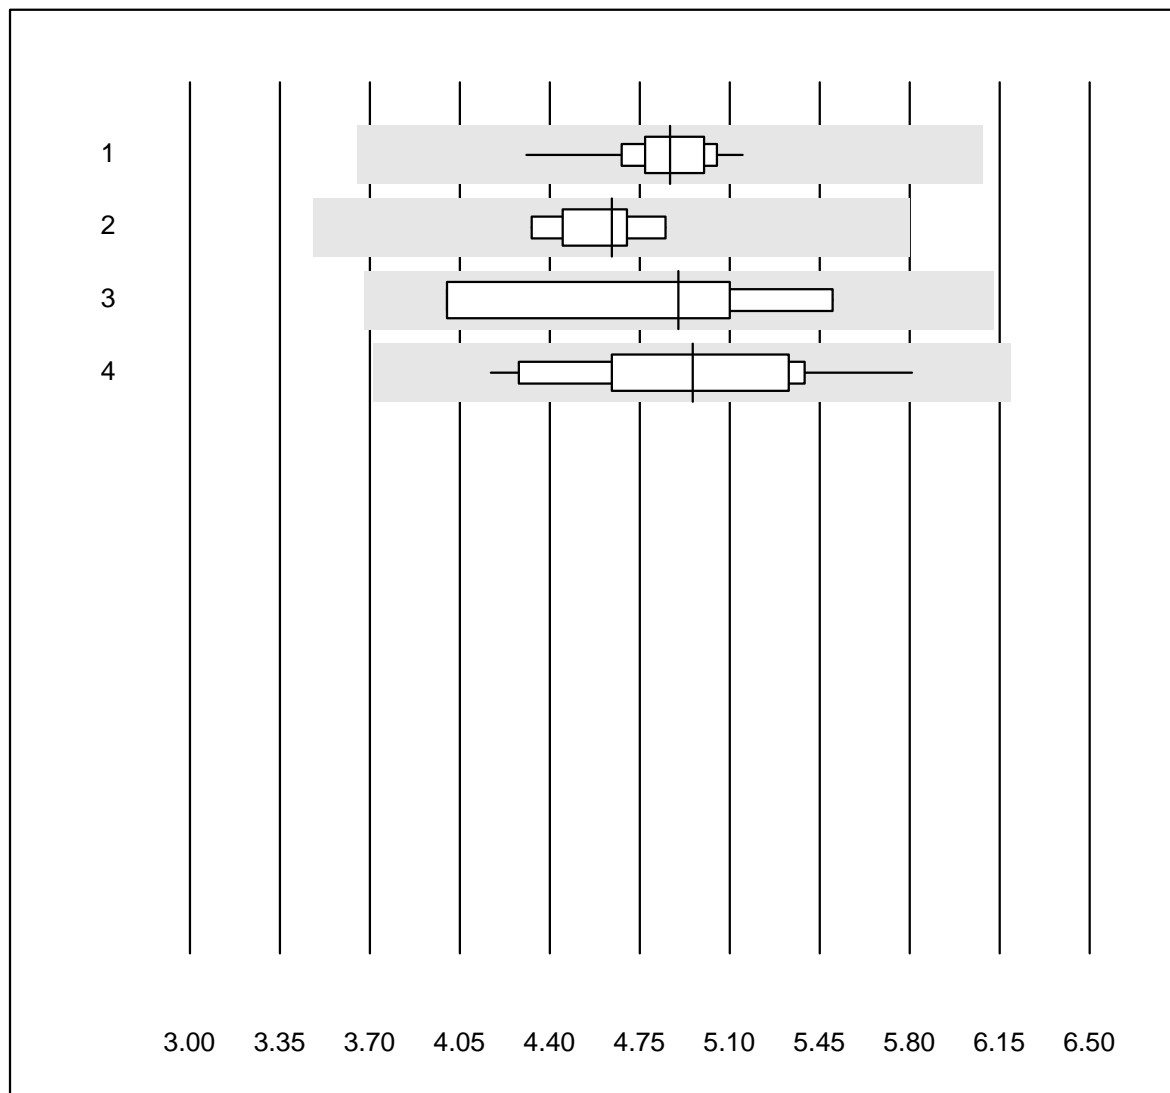


QUALAB Toleranz : 25 %

PSA (µg/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	12	100.0	0.0	0.0	4.87	4.5	e
2 Architect	9	100.0	0.0	0.0	4.64	4.0	e
3 Qualigen	4	100.0	0.0	0.0	4.90	13.3	e*
4 AFIAS	32	93.7	0.0	6.3	4.95	8.8	e

## PSA frei

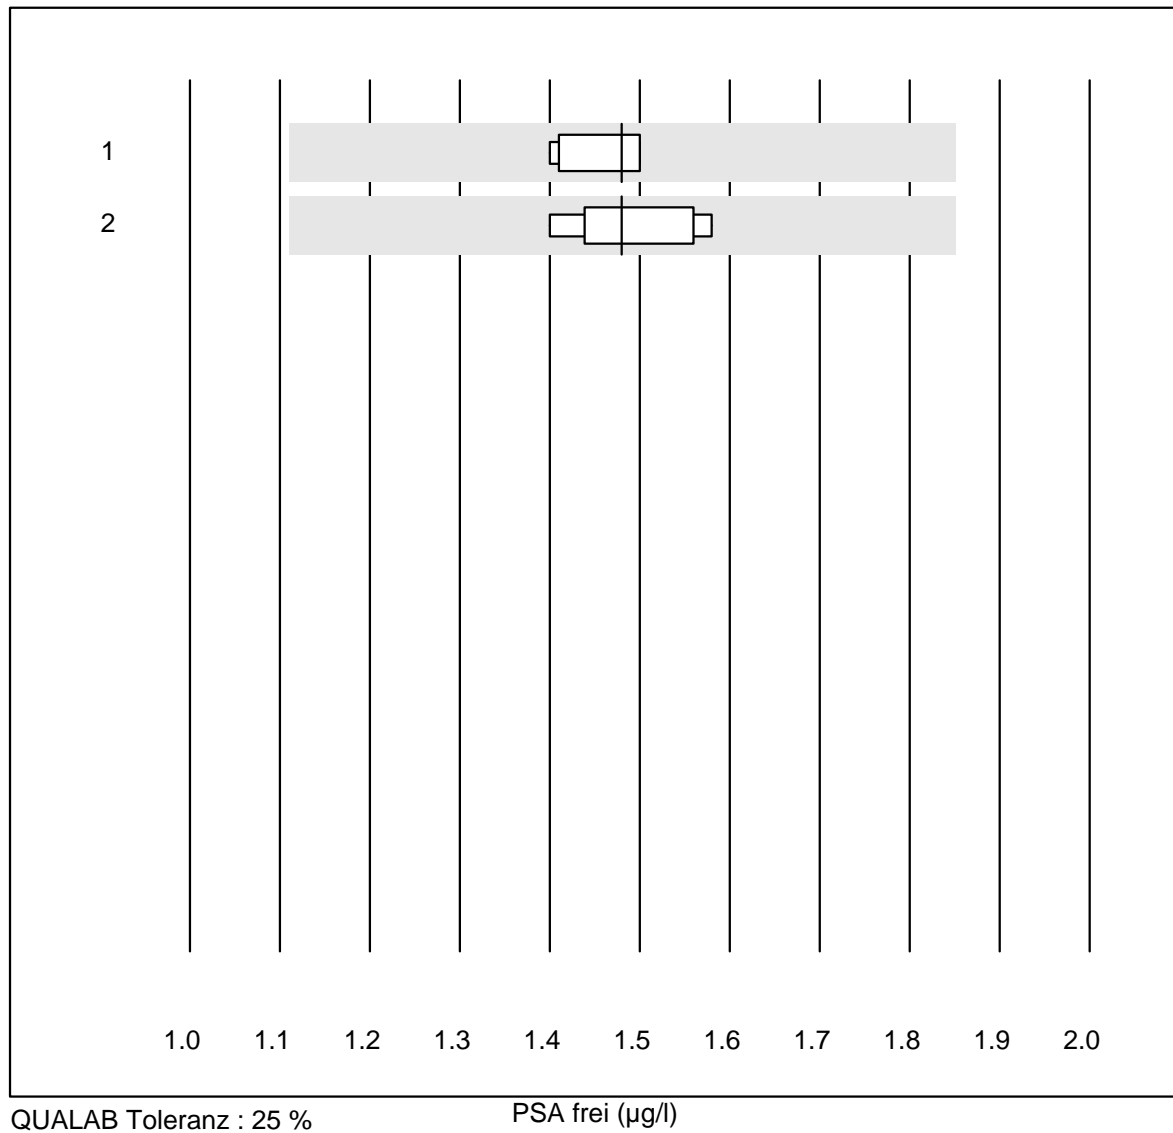

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	7	100.0	0.0	0.0	1.48	2.9	e
2 Architect	7	100.0	0.0	0.0	1.48	4.3	e


# CEA

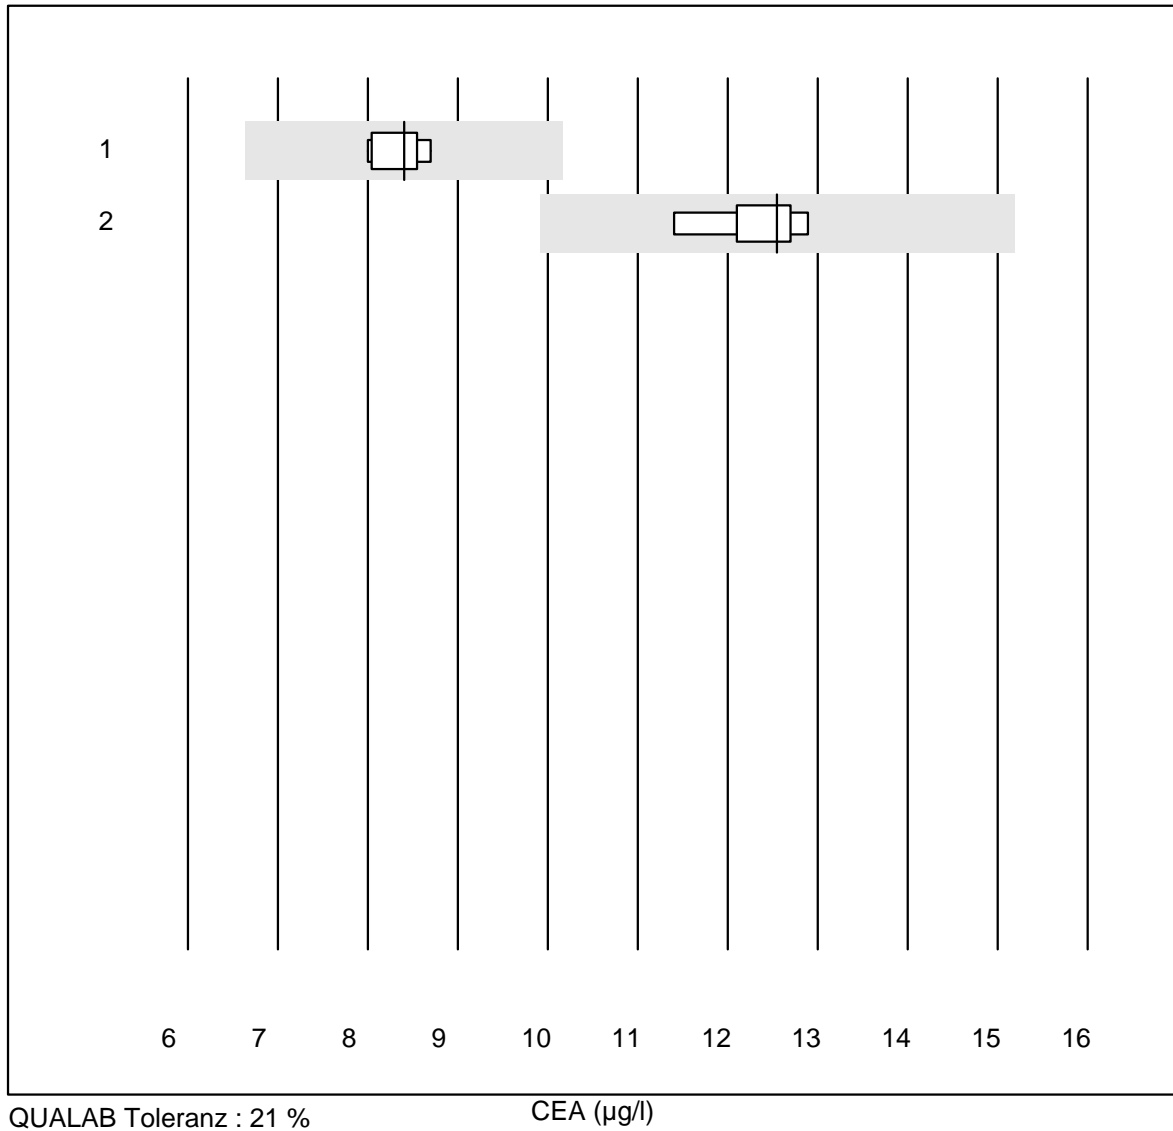

QUALAB Toleranz : 21 %

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	8	100.0	0.0	0.0	8.4	3.4	e
2 Architect	6	100.0	0.0	0.0	12.6	4.4	e

## CA 125

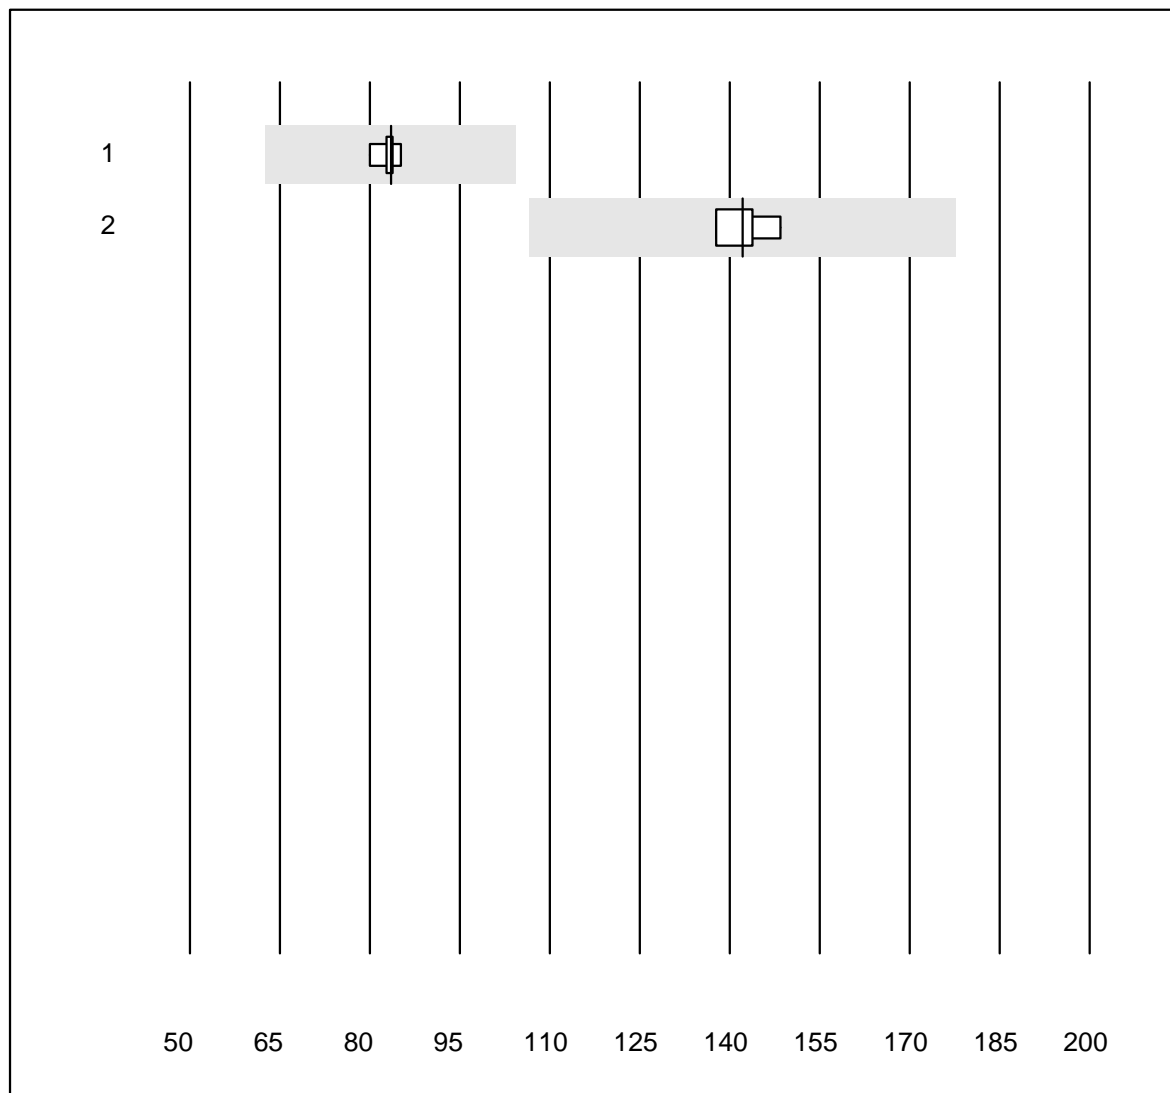


Tolérance MQ : 25 %

CA 125 (kIU/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	5	100.0	0.0	0.0	83.5	2.3	e
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	142.1	3.3	e

## CA 19-9

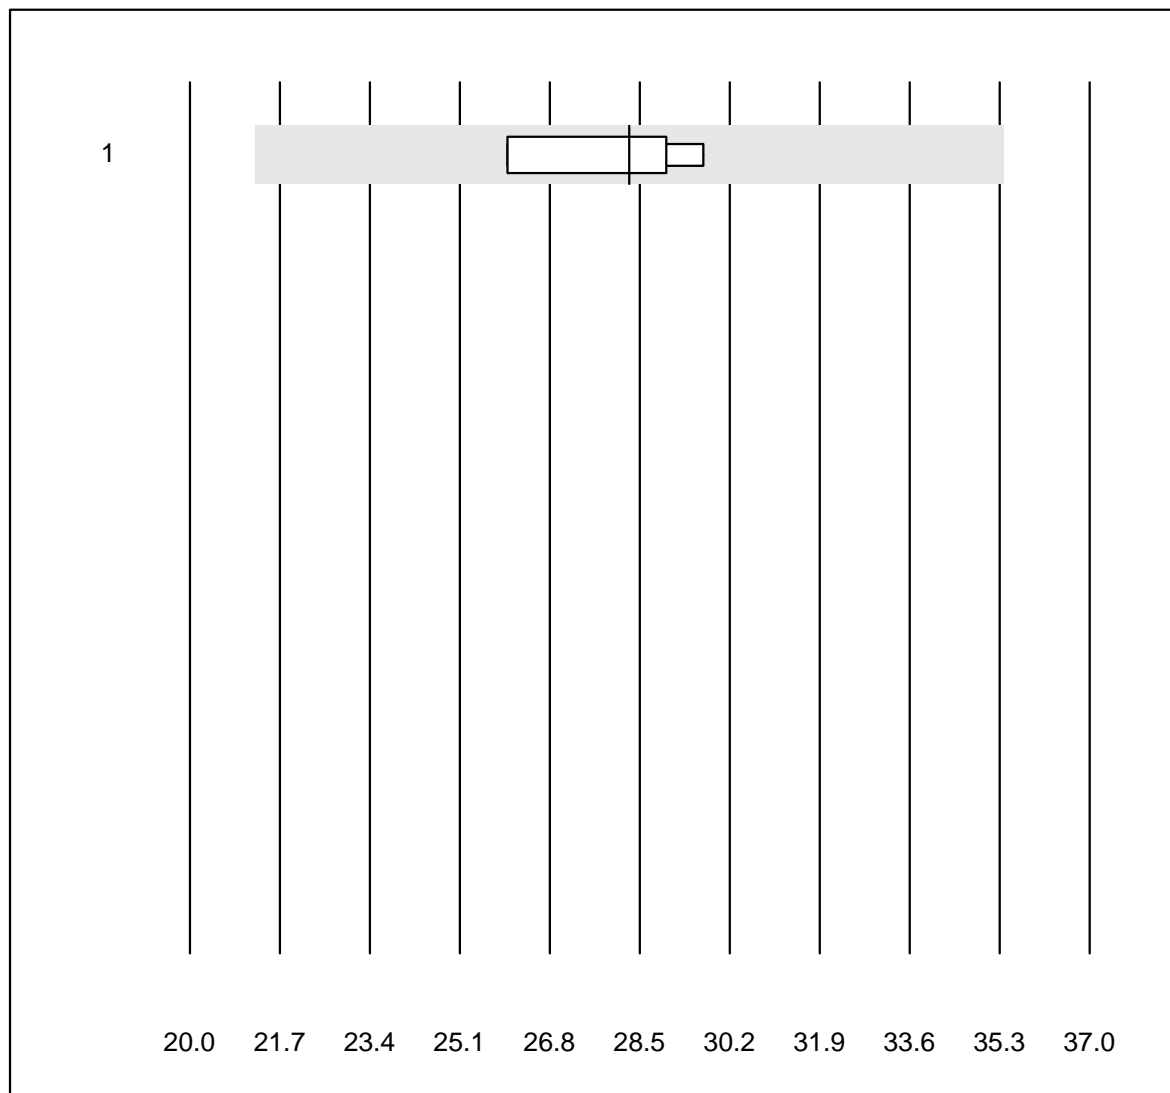


Tolérance MQ : 25 %

CA 19-9 (kIU/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	4	100.0	0.0	0.0	28.3	5.8	e

## CA 15-3

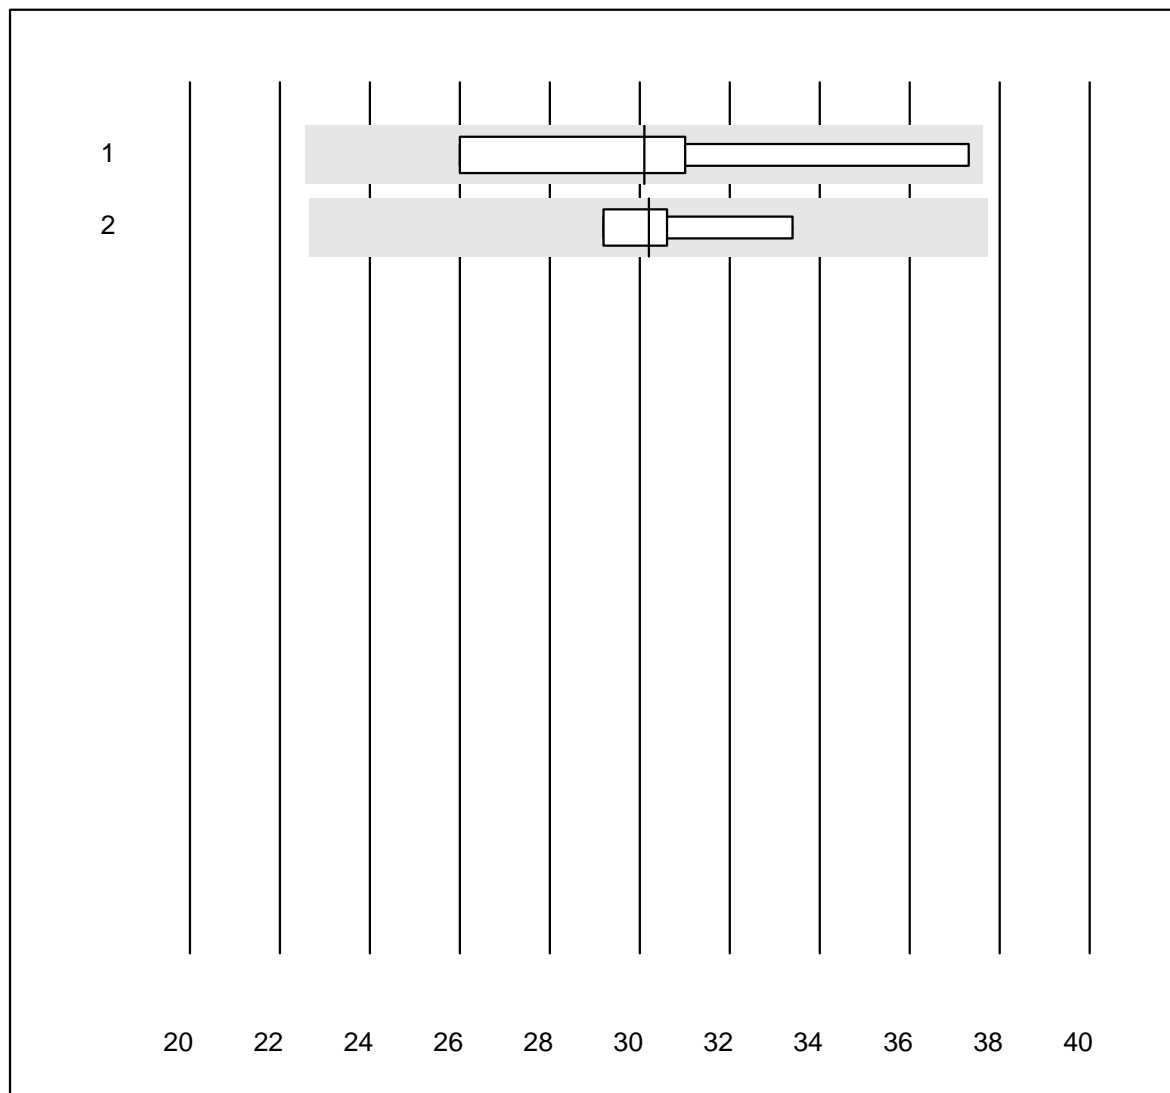


Tolérance MQ : 25 %

CA 15-3 (kIU/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	6	100.0	0.0	0.0	30.1	13.8	a
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	30.2	6.4	a


# AFP

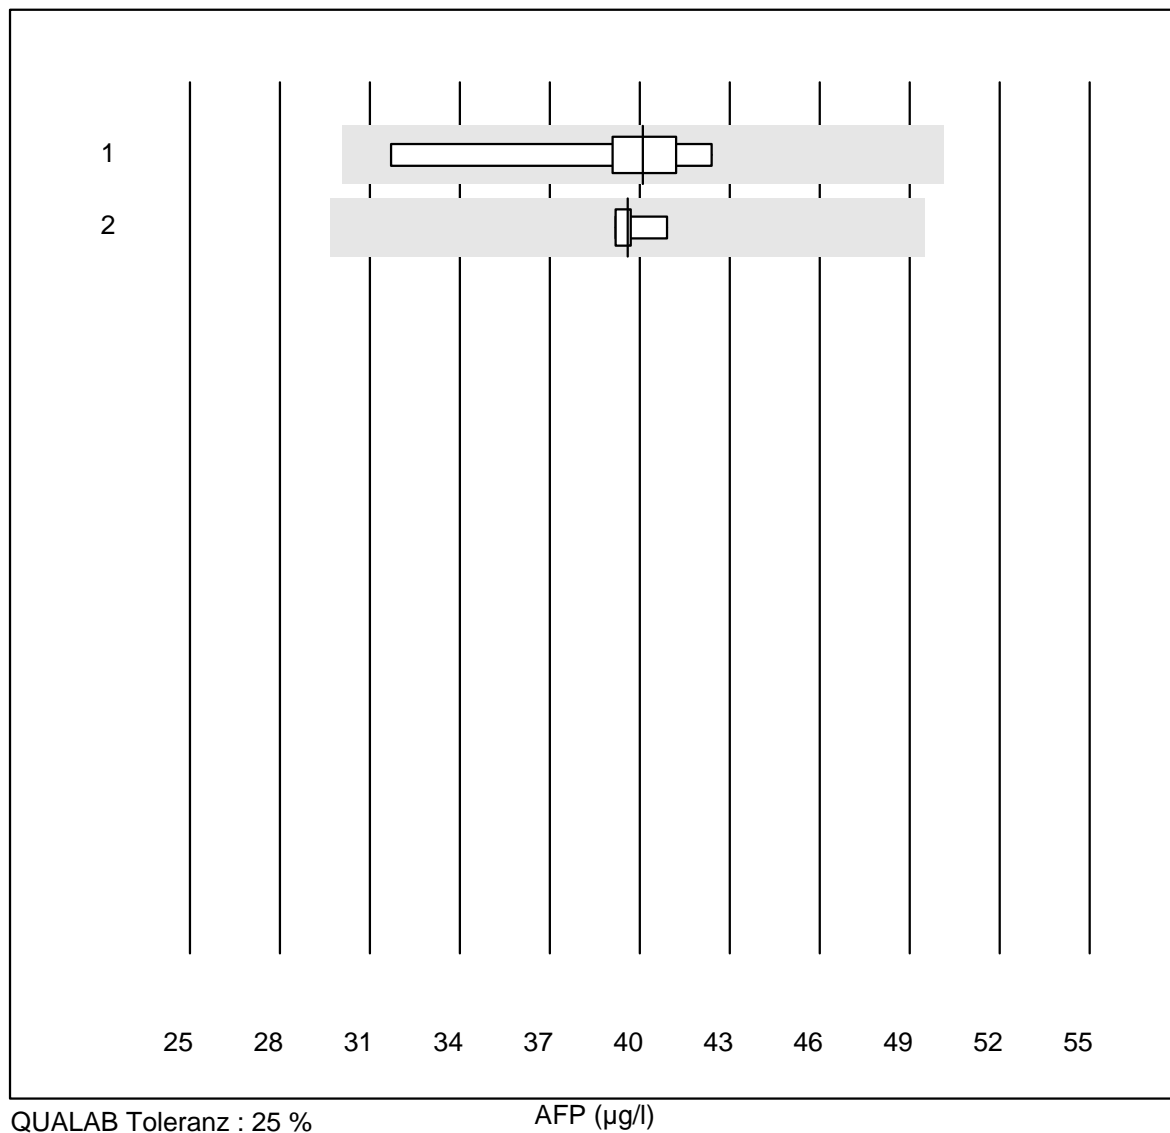

QUALAB Toleranz : 25 %

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	5	100.0	0.0	0.0	40.1	10.8	e*
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	39.6	1.9	e


## HCG qn

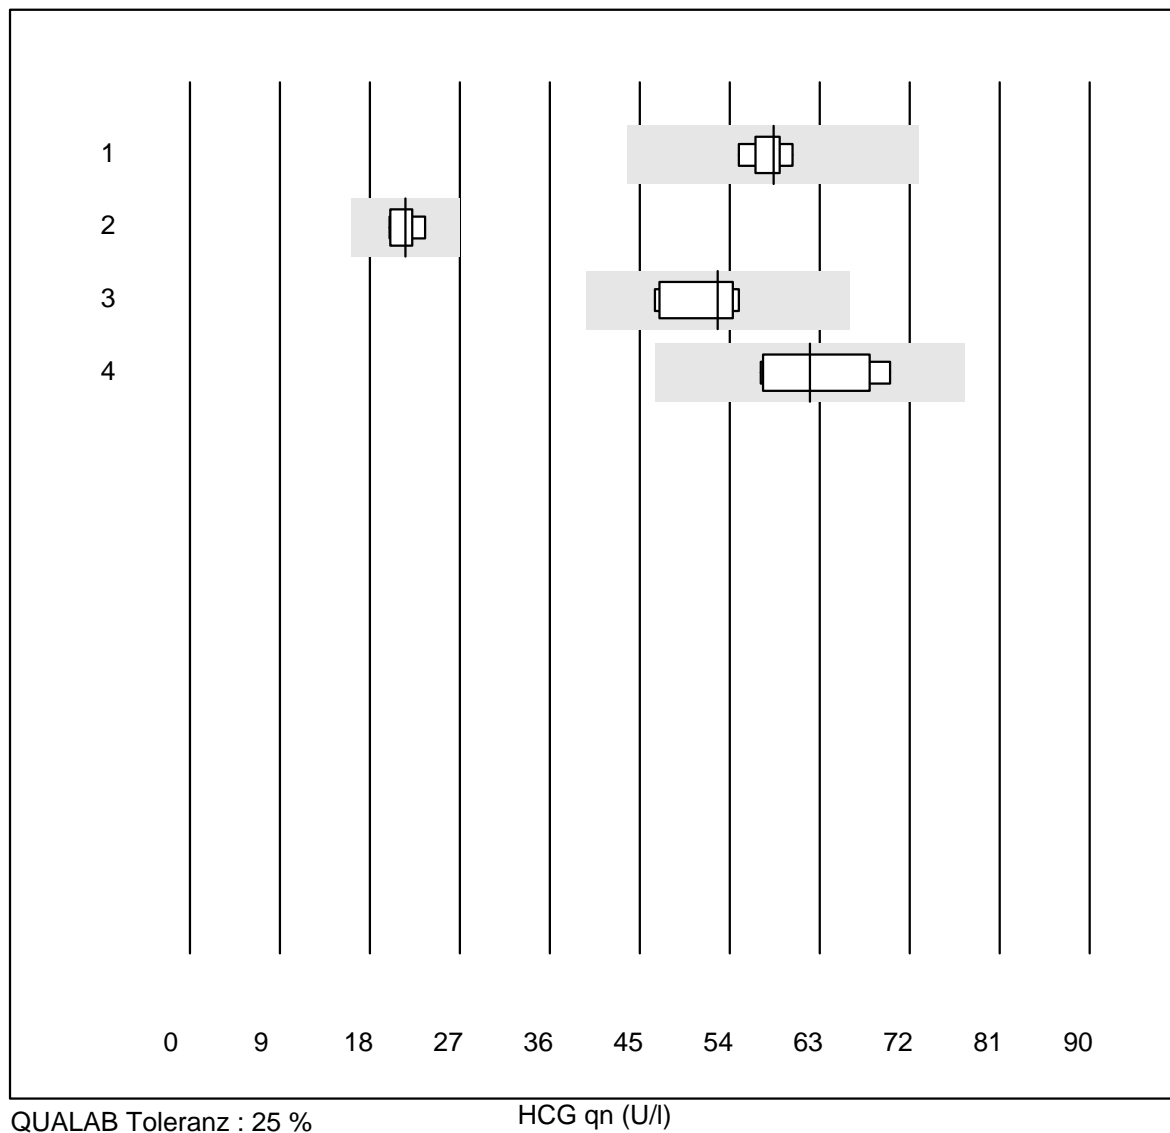

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	8	100.0	0.0	0.0	58.4	3.1	e
2 VIDAS	8	100.0	0.0	0.0	21.6	6.5	e
3 Architect	7	85.7	0.0	14.3	52.8	7.2	e
4 AFIAS	9	100.0	0.0	0.0	62.0	8.7	e




## CK-MB

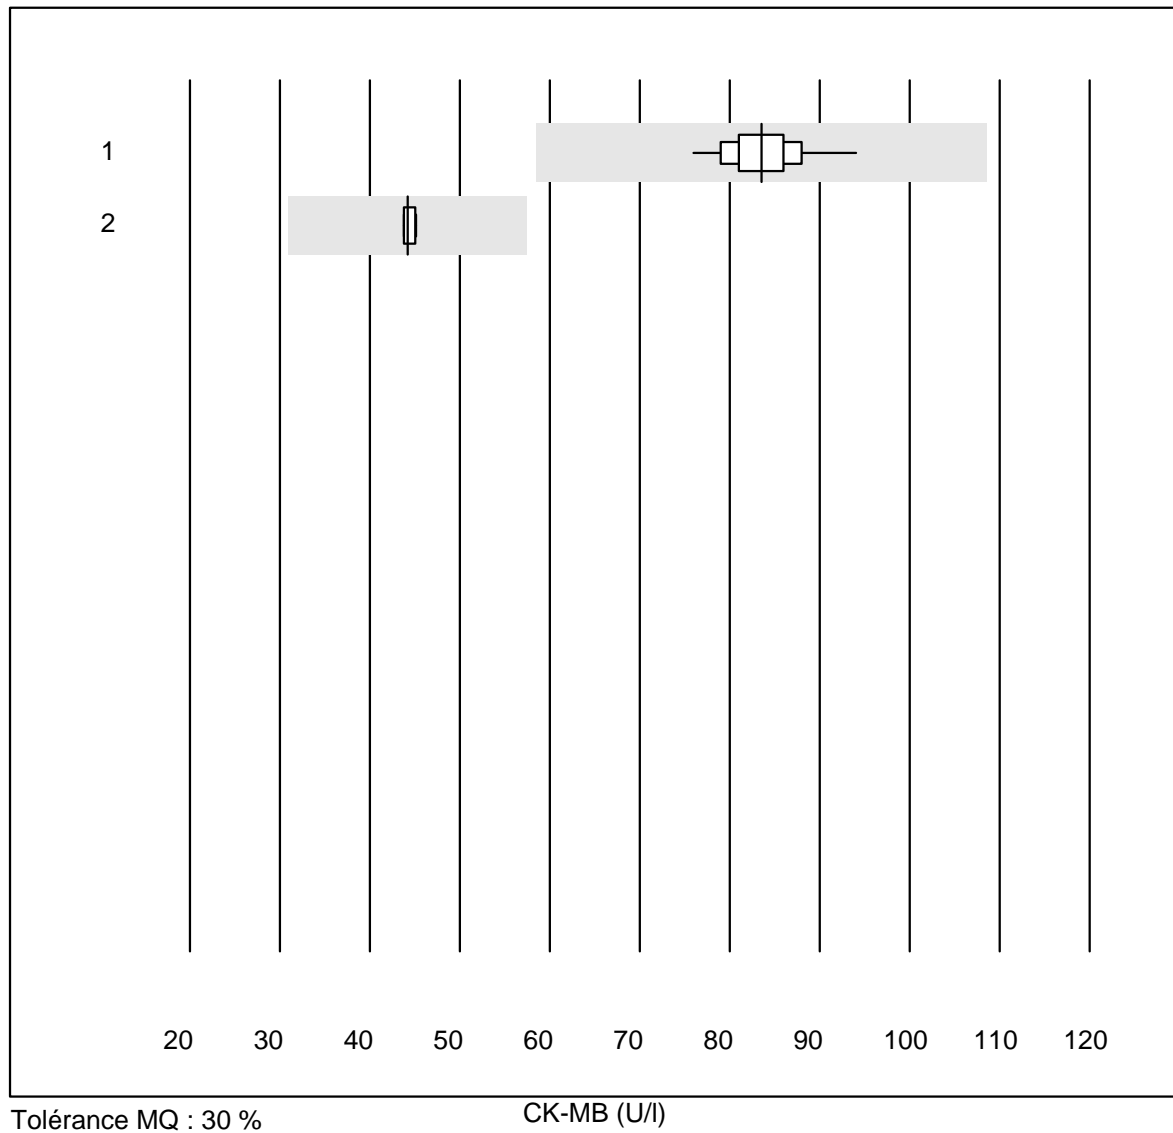


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Fuji Dri-Chem	32	96.9	0.0	3.1	83.5	5.0	e
2 Cobas/Roche	5	100.0	0.0	0.0	44.2	1.4	e

# BNP

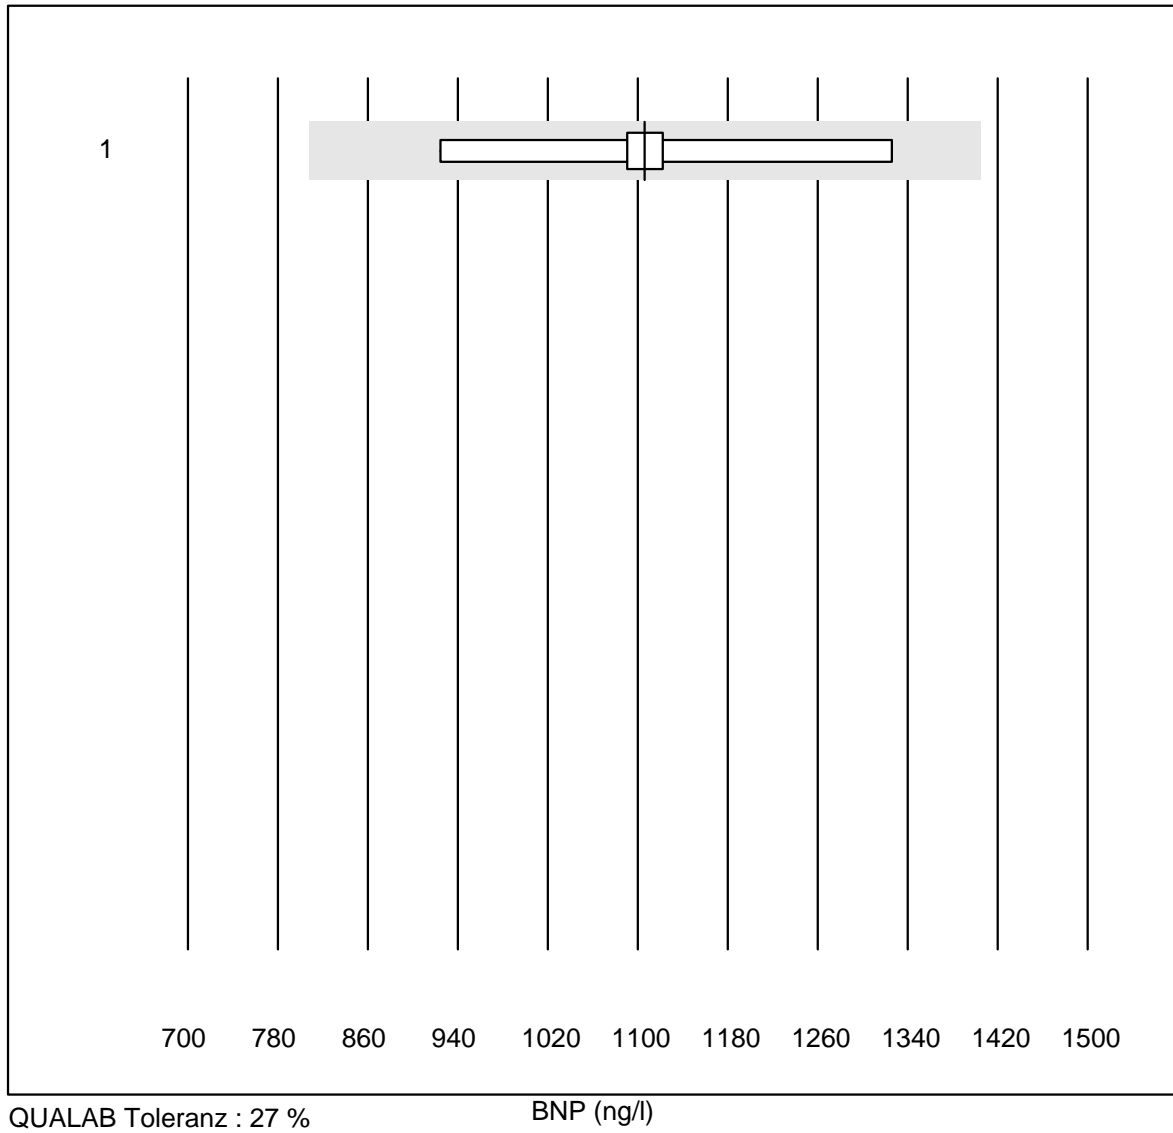

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Architect	5	100.0	0.0	0.0	1106.0	12.8	e*

## Cholésterol PTS

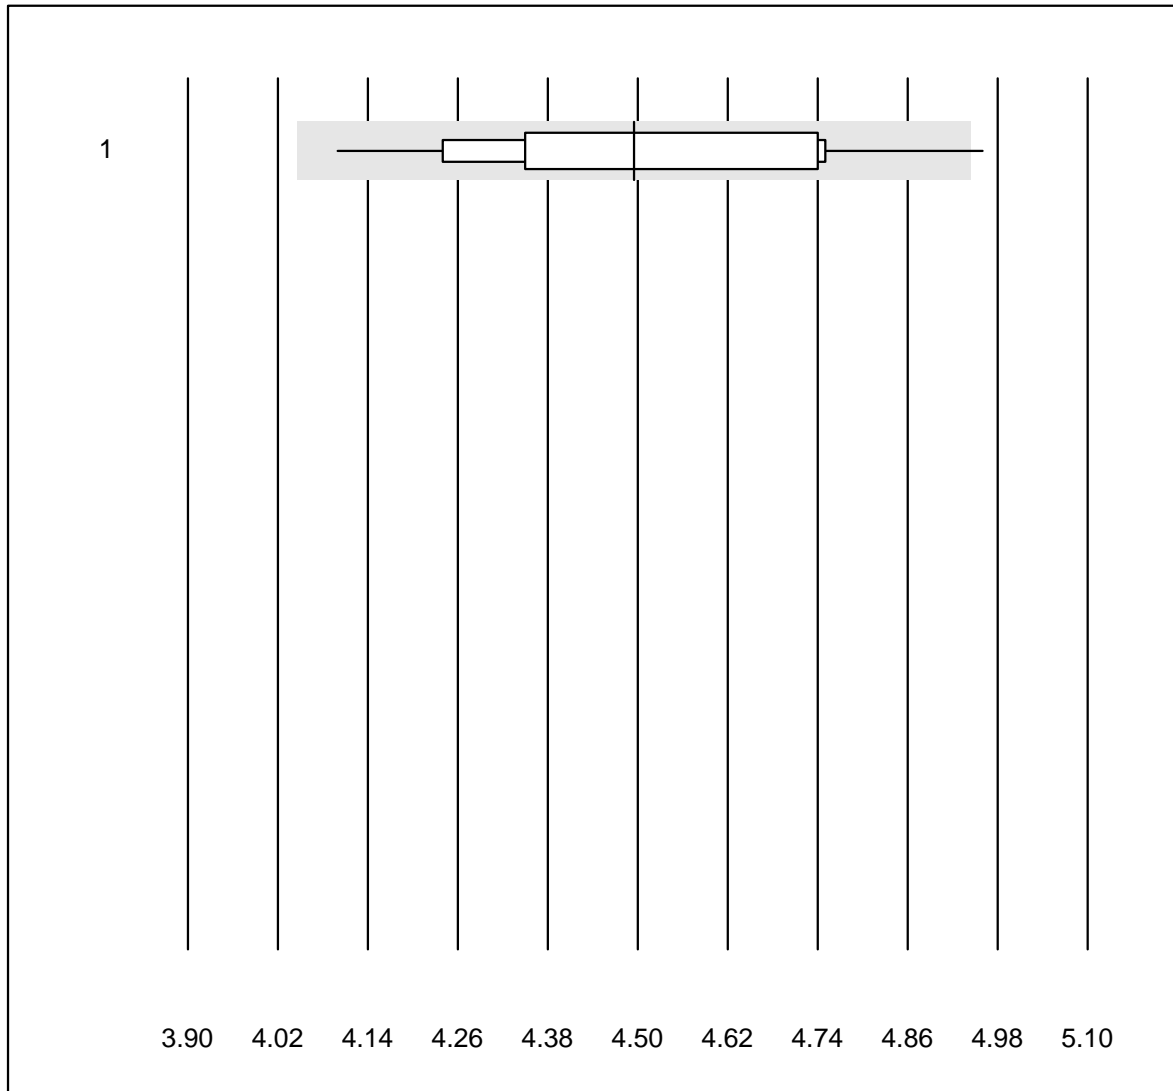


QUALAB Toleranz : 10 %

Cholésterol PTS (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 CardioChek	11	90.9	9.1	0.0	4.49	5.5	e*

## Cholésterol HDL PTS

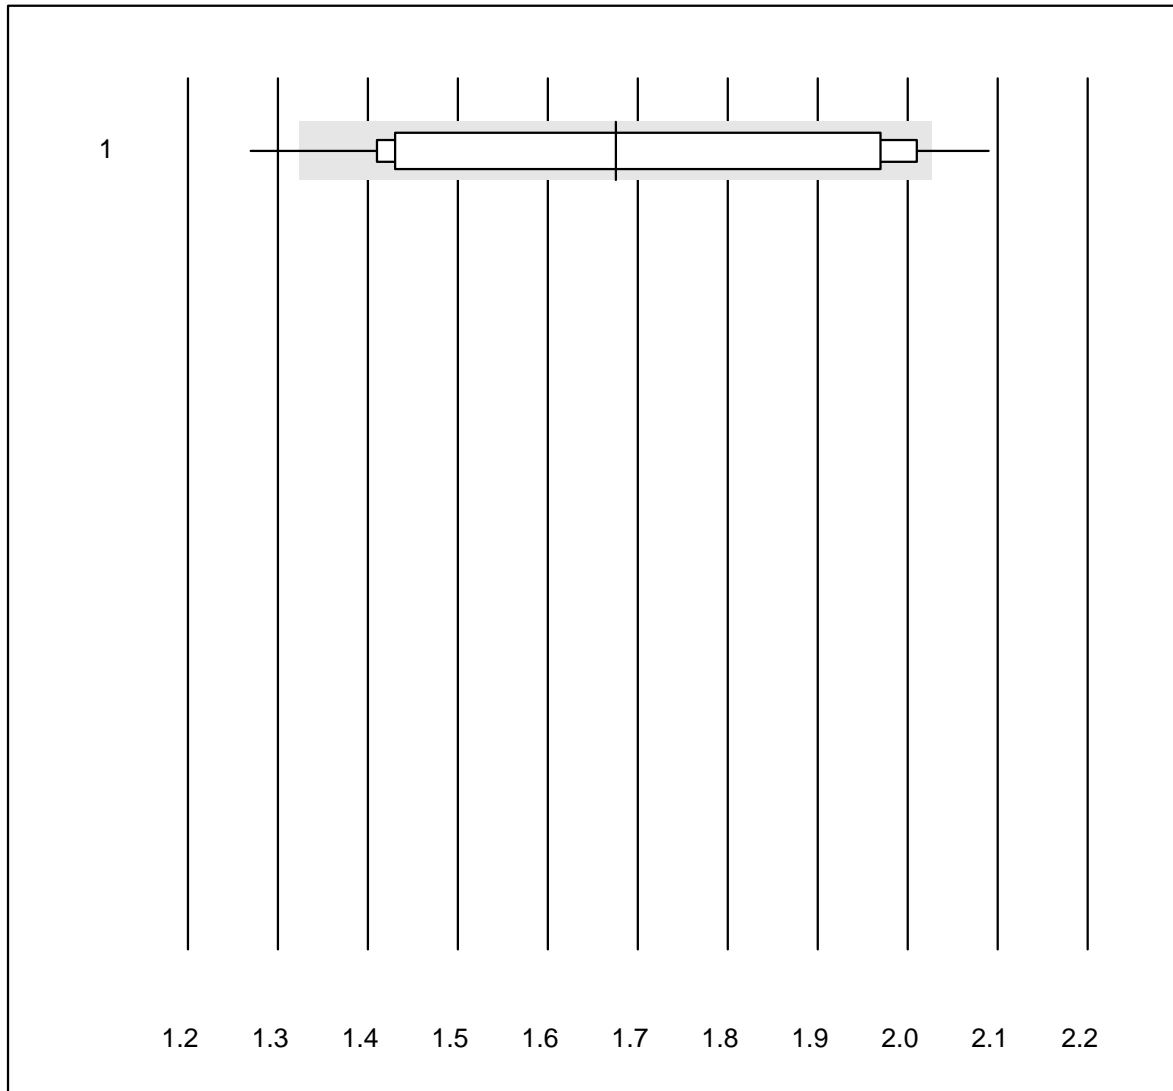


QUALAB Toleranz : 21 %

Cholésterol HDL PTS (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 CardioChek	11	81.8	18.2	0.0	1.68	16.6	e*

## Triglyc rides PTS

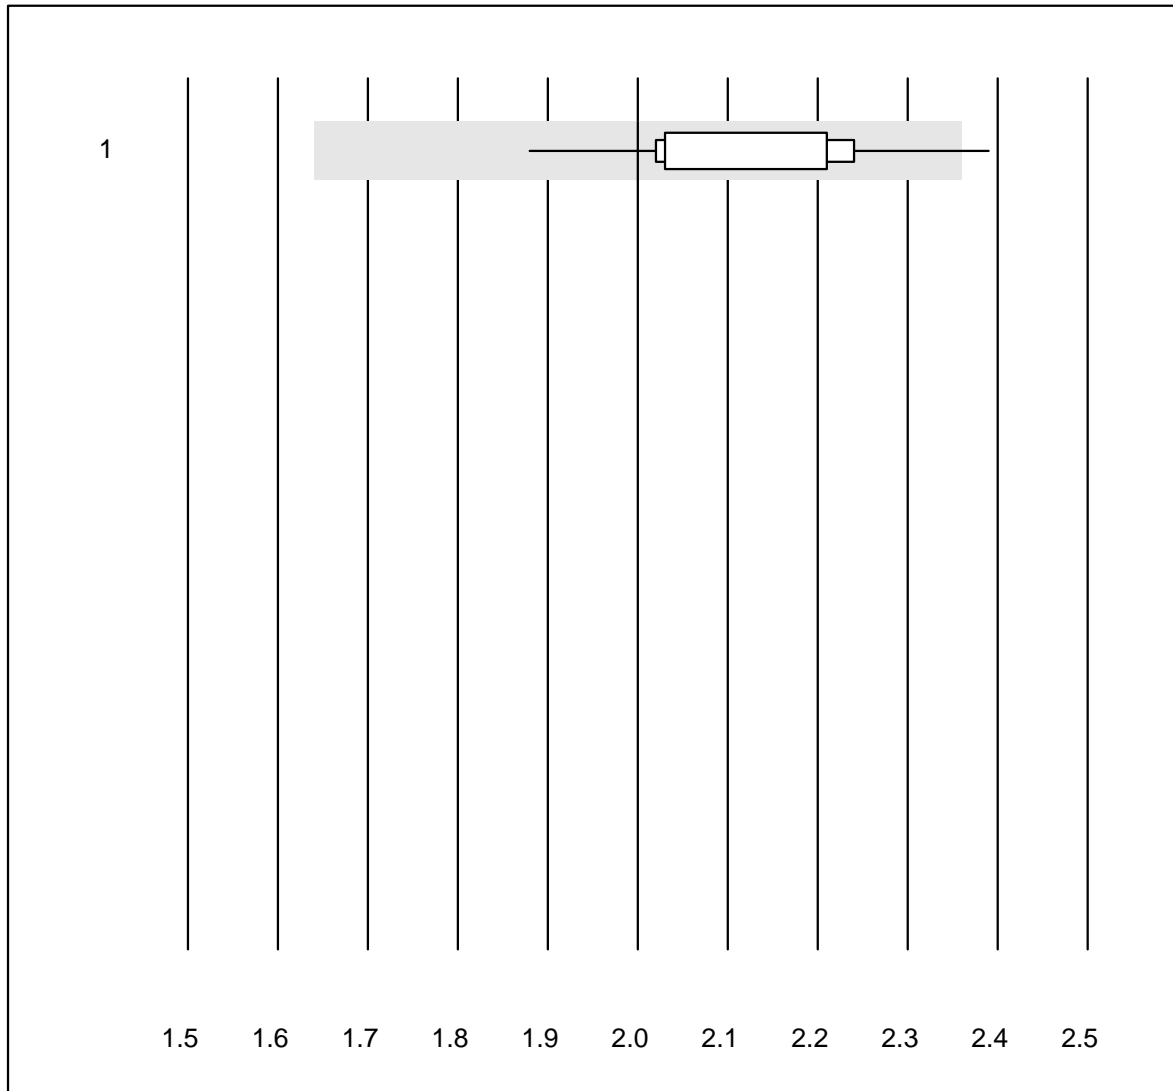


QUALAB Toleranz : 18 %

Triglyc rides PTS (mmol/l)


Nr. Methode	Total	% Erf�llt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 CardioChek	11	90.9	9.1	0.0	2.00	6.3	a

## C-Peptid

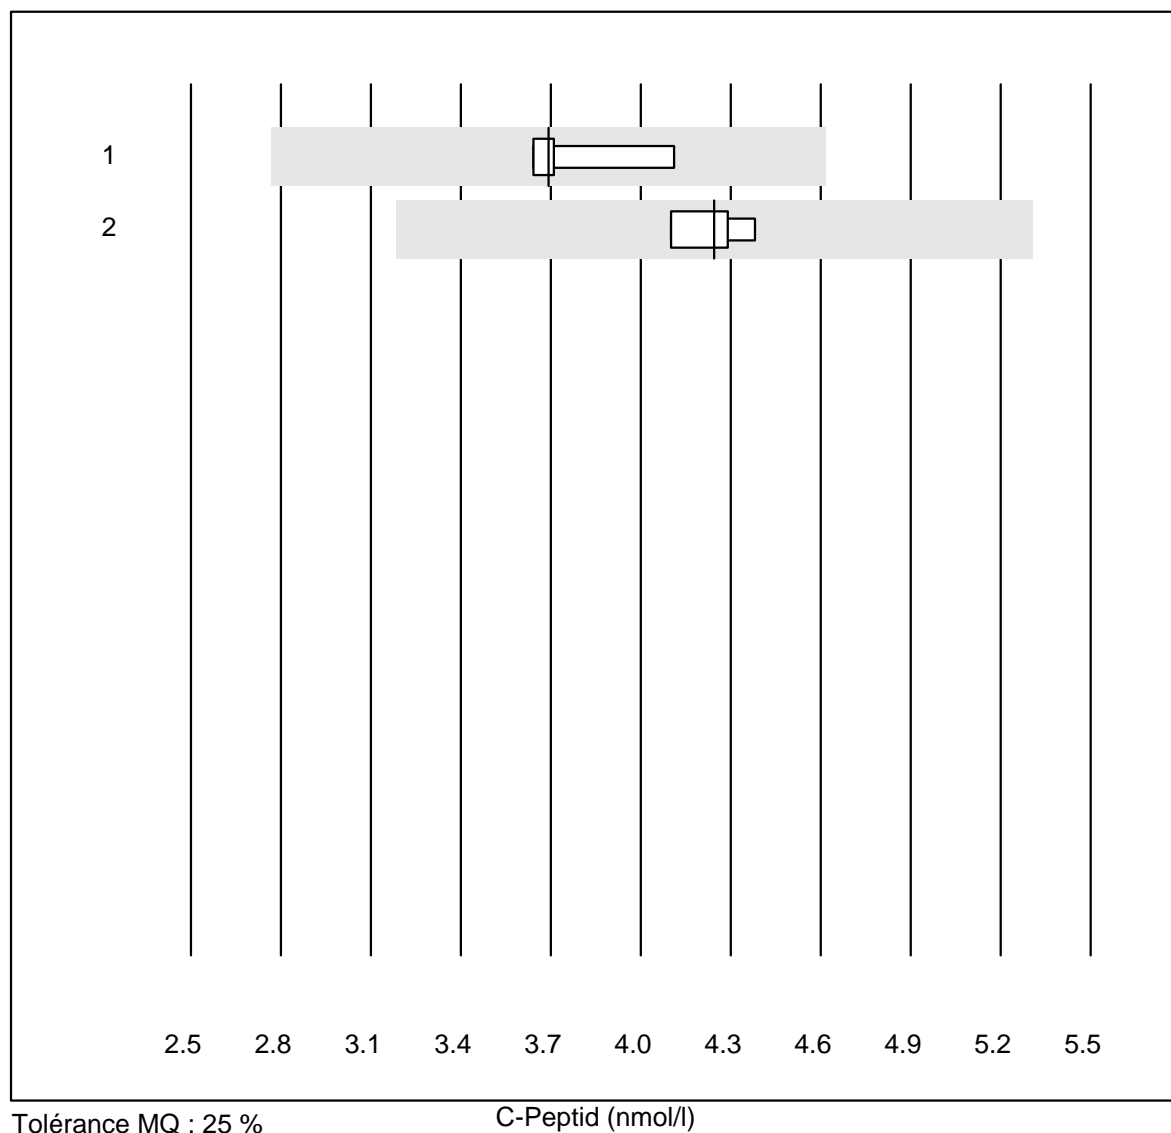


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	3.69	5.8	e
2 Liaison	4	100.0	0.0	0.0	4.25	2.8	e

## Procalcitonine

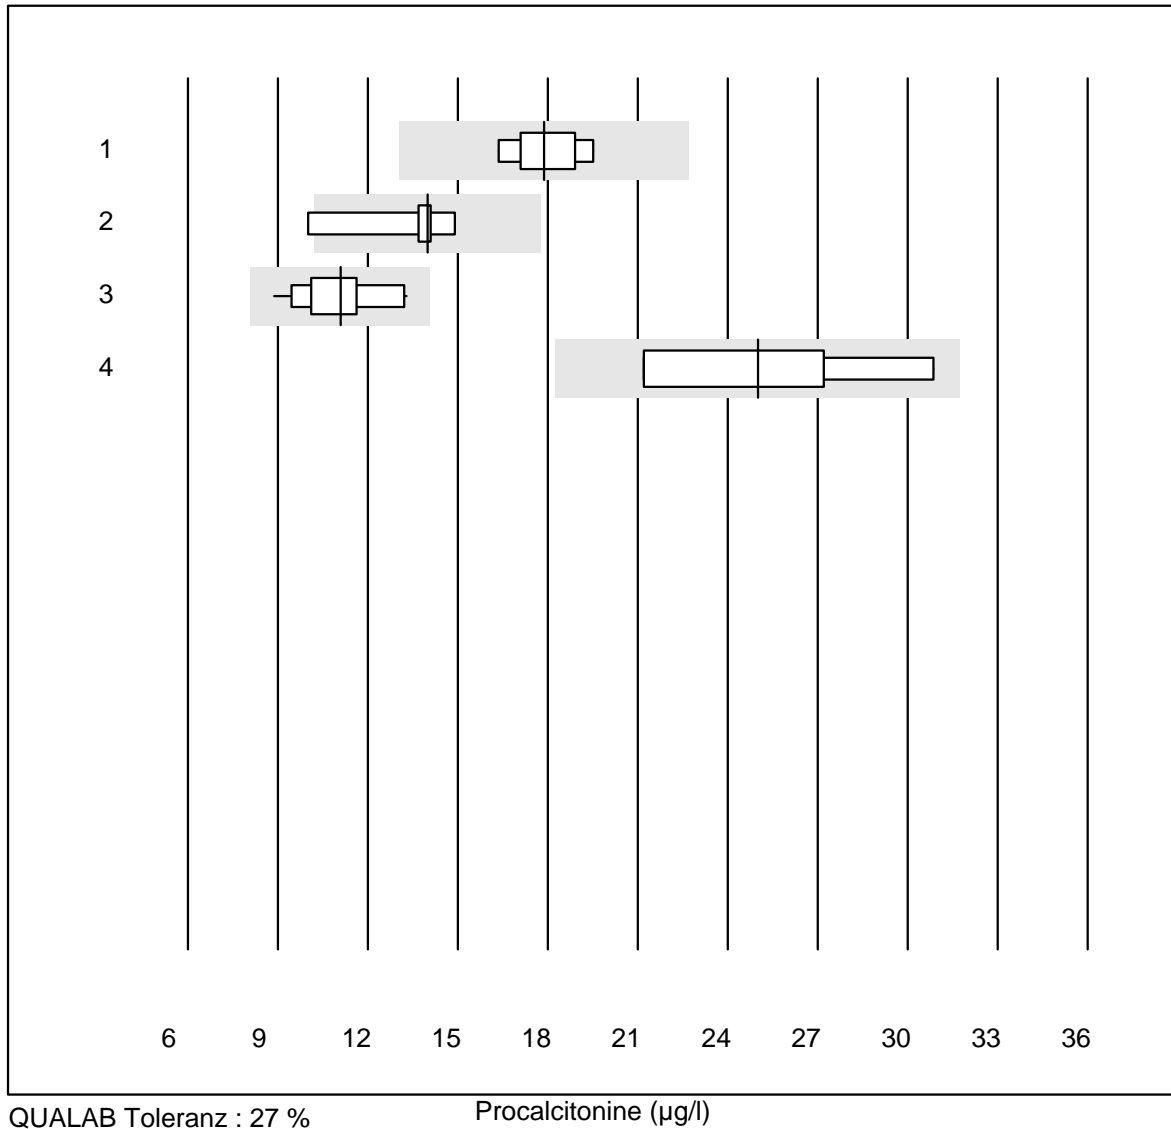

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Architect	6	100.0	0.0	0.0	17.87	6.4	e
2 Cobas	9	88.9	11.1	0.0	14.00	10.6	e*
3 VIDAS	13	100.0	0.0	0.0	11.08	12.7	e*
4 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	25.00	17.1	e*

# EPO

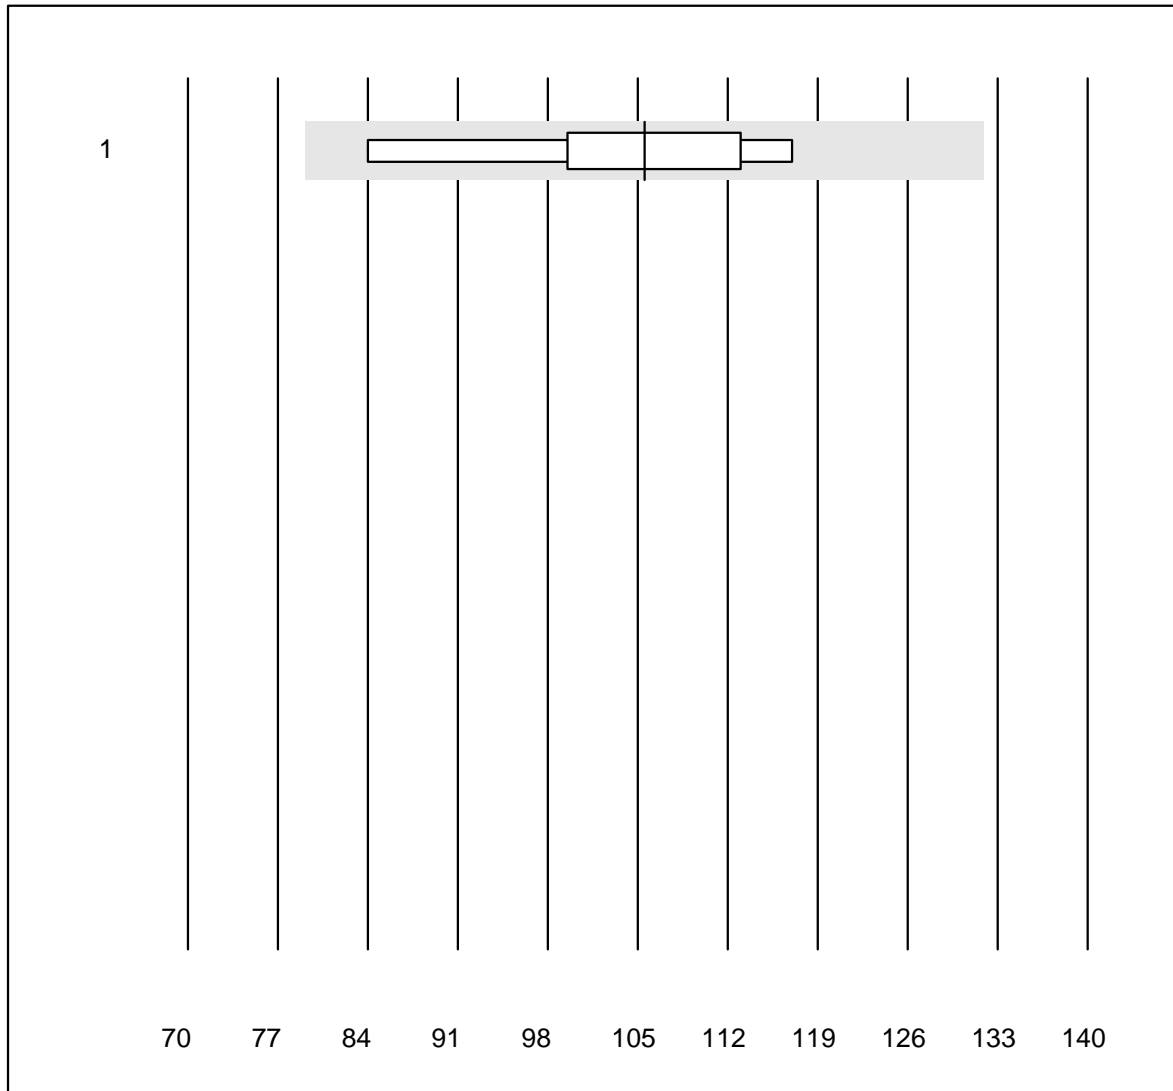


Tolérance MQ : 25 %

EPO (U/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Immulite	6	100.0	0.0	0.0	105.5	11.2	e*




## Parathormone

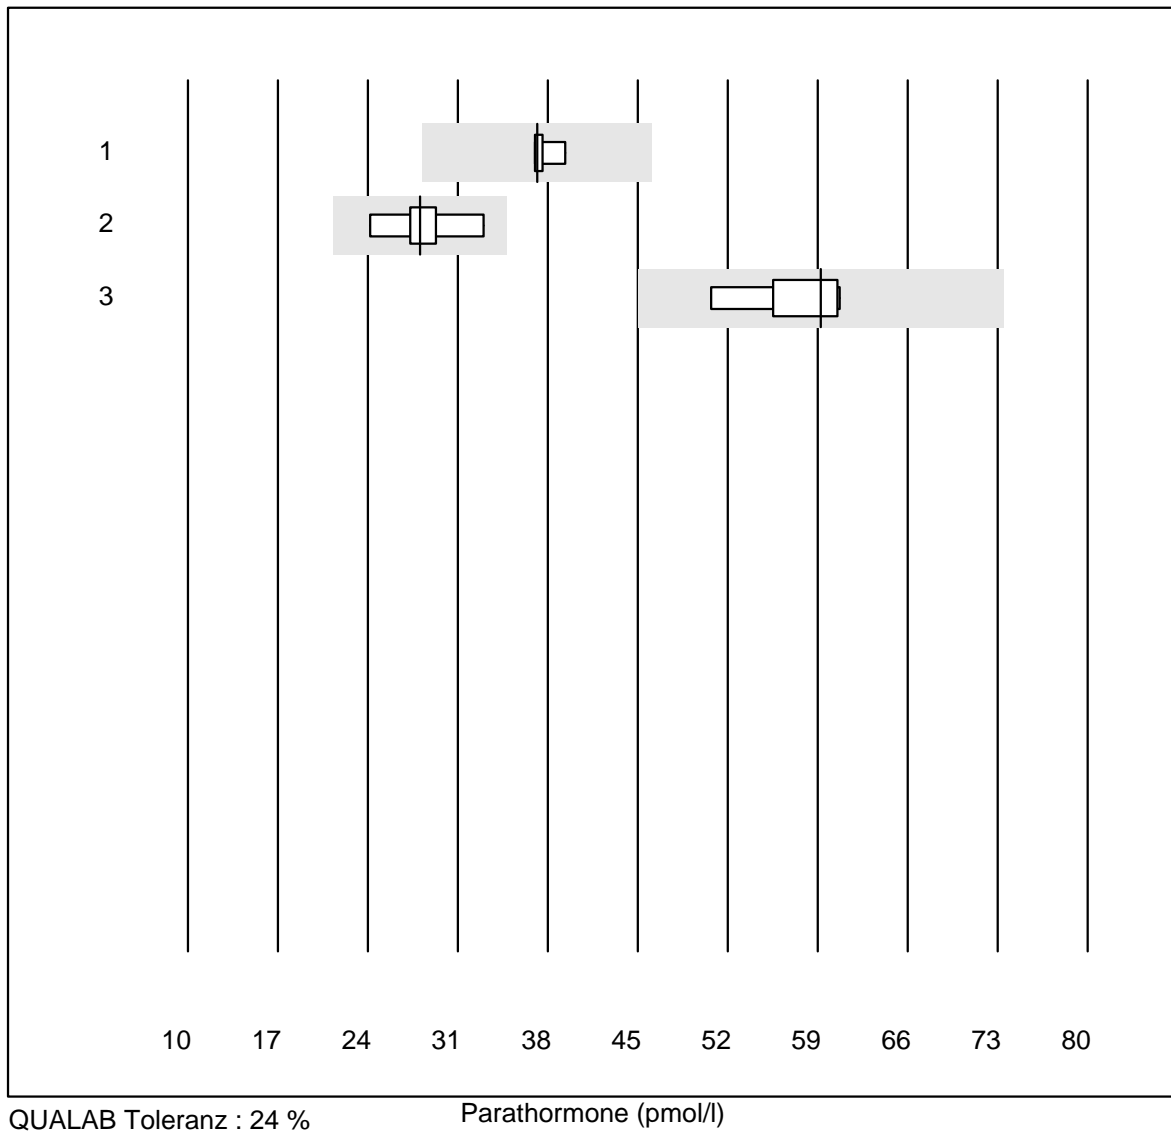

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas PTH STAT	5	100.0	0.0	0.0	37.2	2.7	e
2	Cobas	9	100.0	0.0	0.0	28.0	8.7	e*
3	Architect	5	100.0	0.0	0.0	59.3	7.4	e*


# Osmolalität

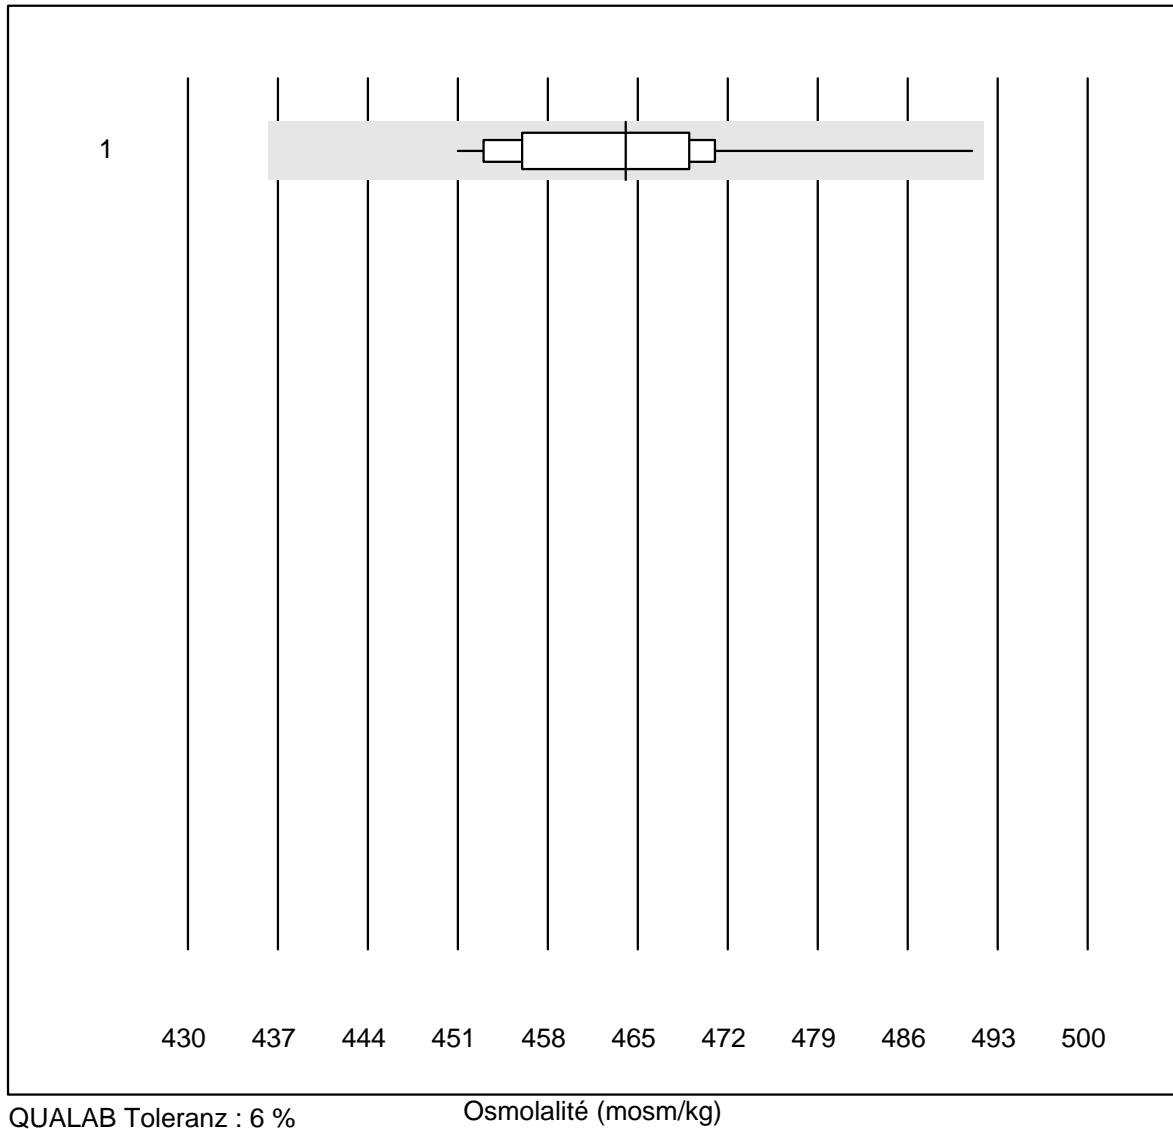

QUALAB Toleranz : 6 %

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cryoscopie	17	94.1	0.0	5.9	464	2.1	e

# Kalium-K22

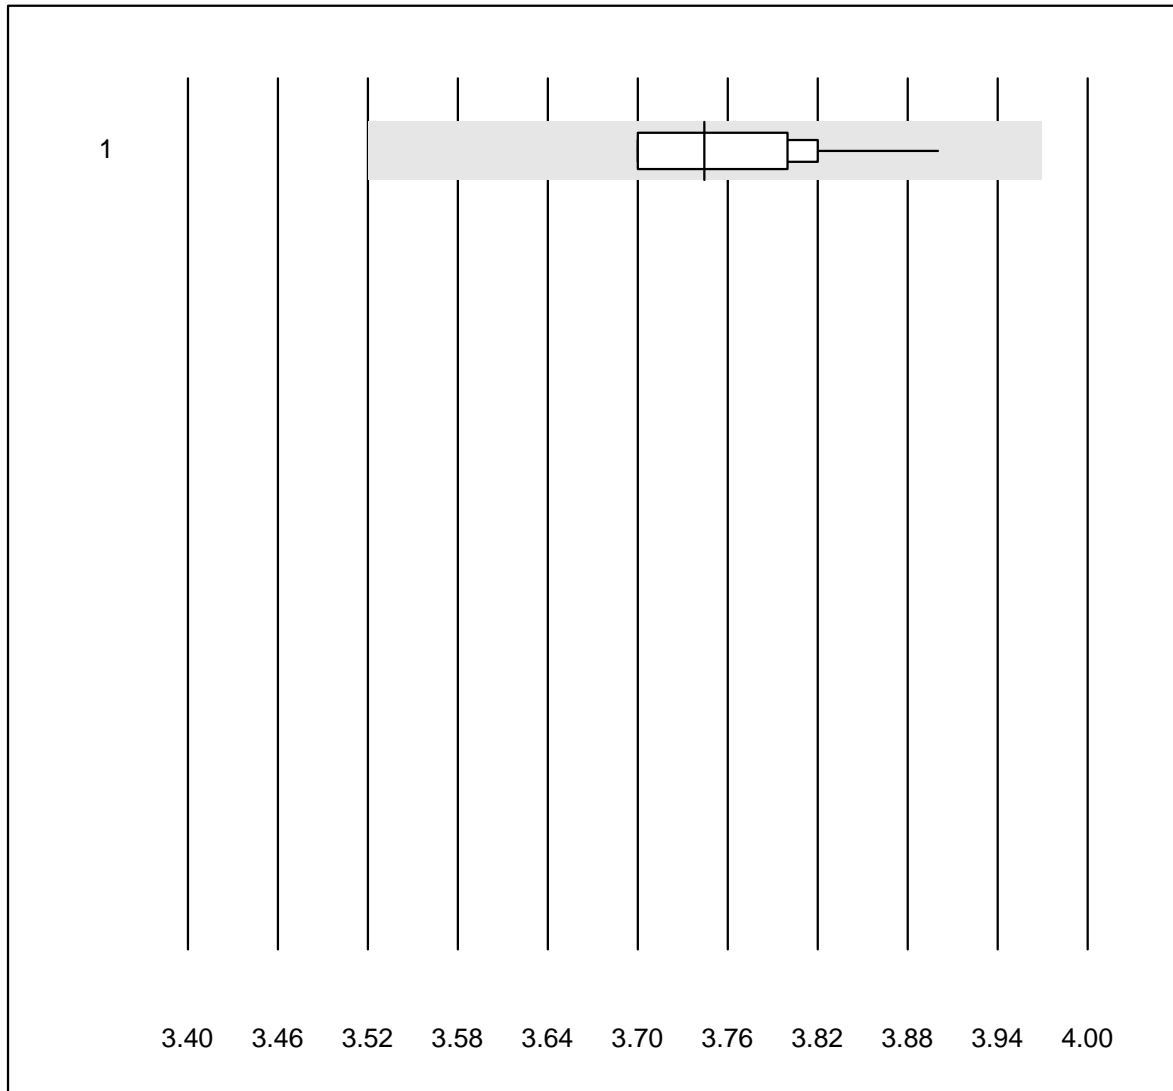


QUALAB Toleranz : 6 %

Kalium-K22 (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 ISE	11	100.0	0.0	0.0	3.7	1.8	e

## Natrium-K22

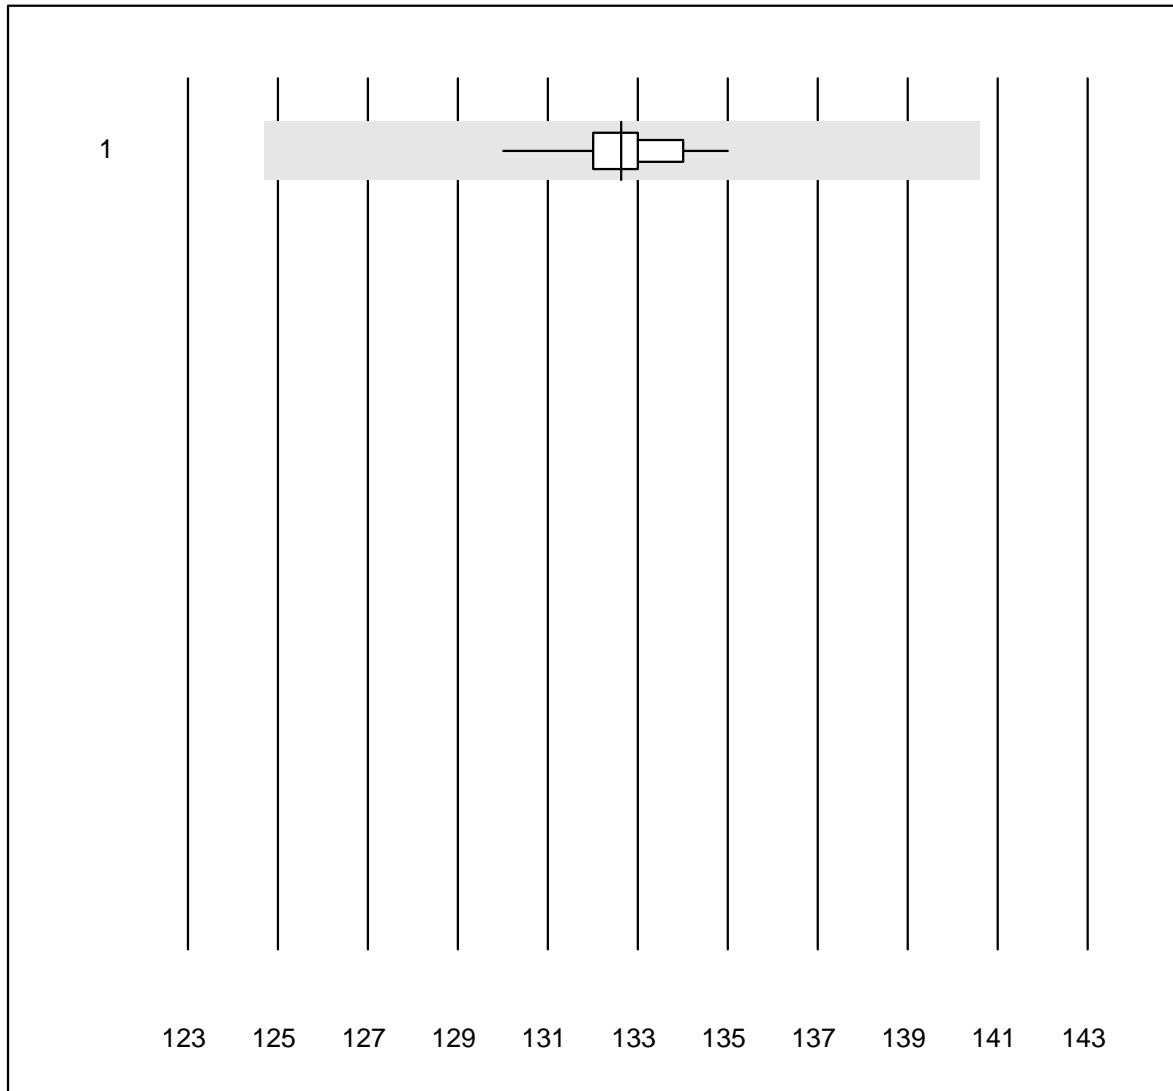


QUALAB Toleranz : 6 %

Natrium-K22 (mmol/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 ISE	11	100.0	0.0	0.0	133	1.0	e

## Glukose-K22

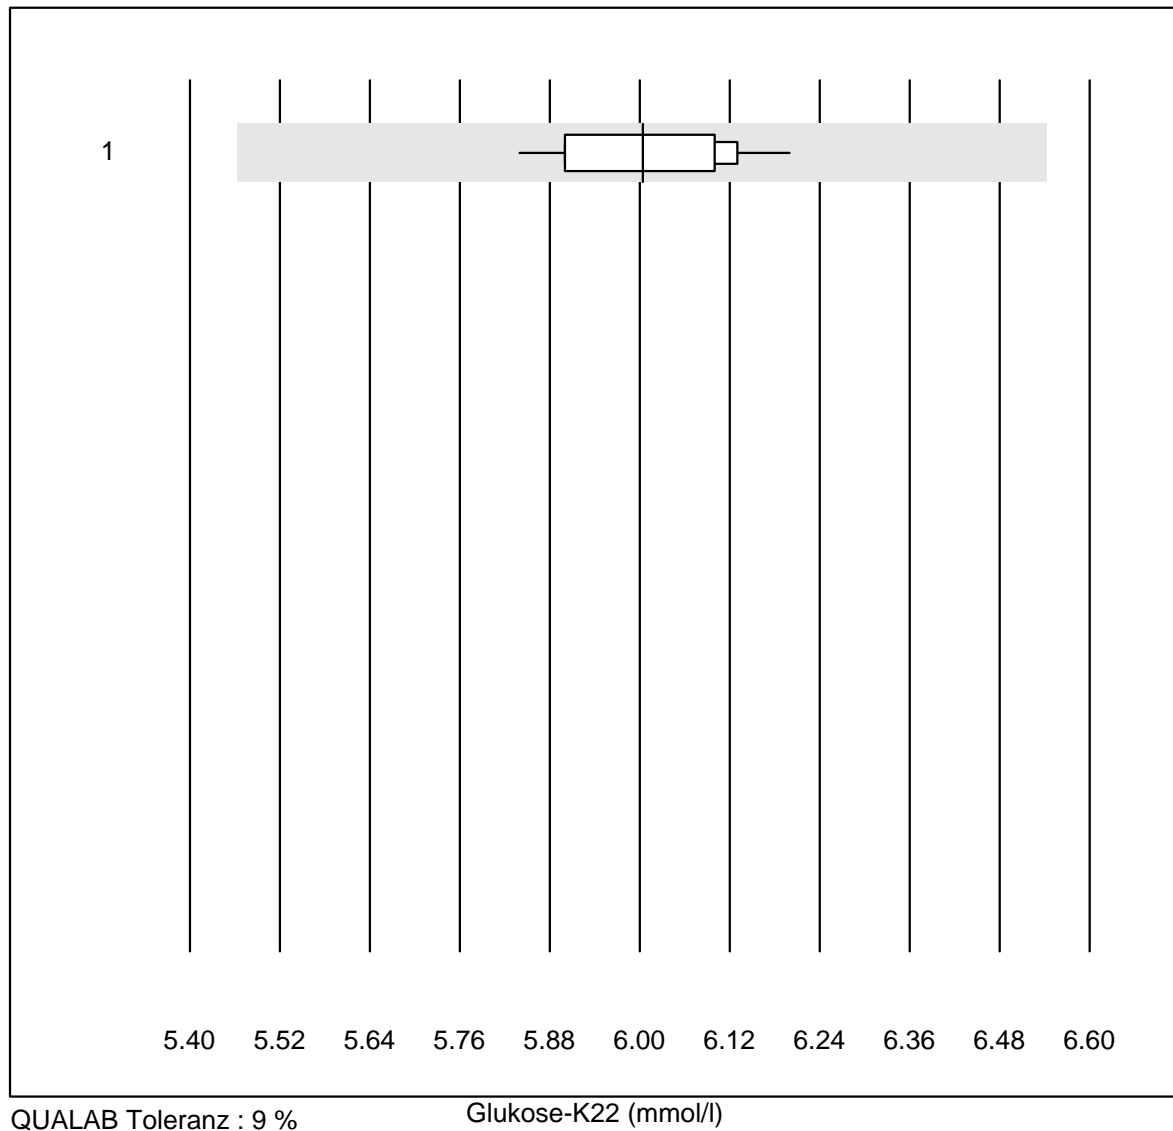

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	11	100.0	0.0	0.0	6.0	1.9	e

## Harnstoff-K22

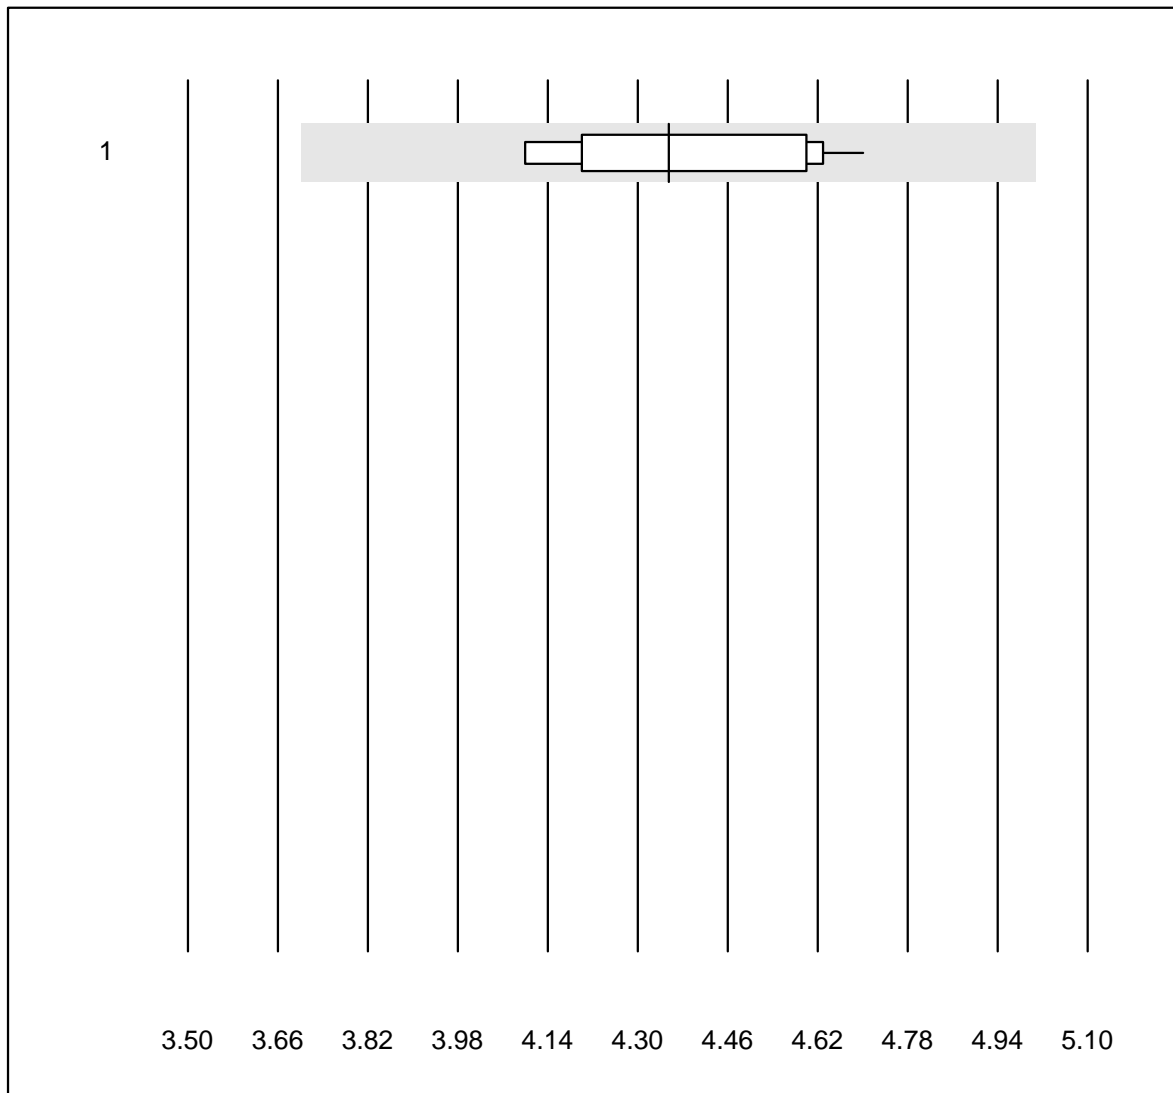


QUALAB Toleranz : 15 %

Harnstoff-K22 (mmol/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Chimie humide	11	100.0	0.0	0.0	4.4	4.7	e

## Osmotische Lücke

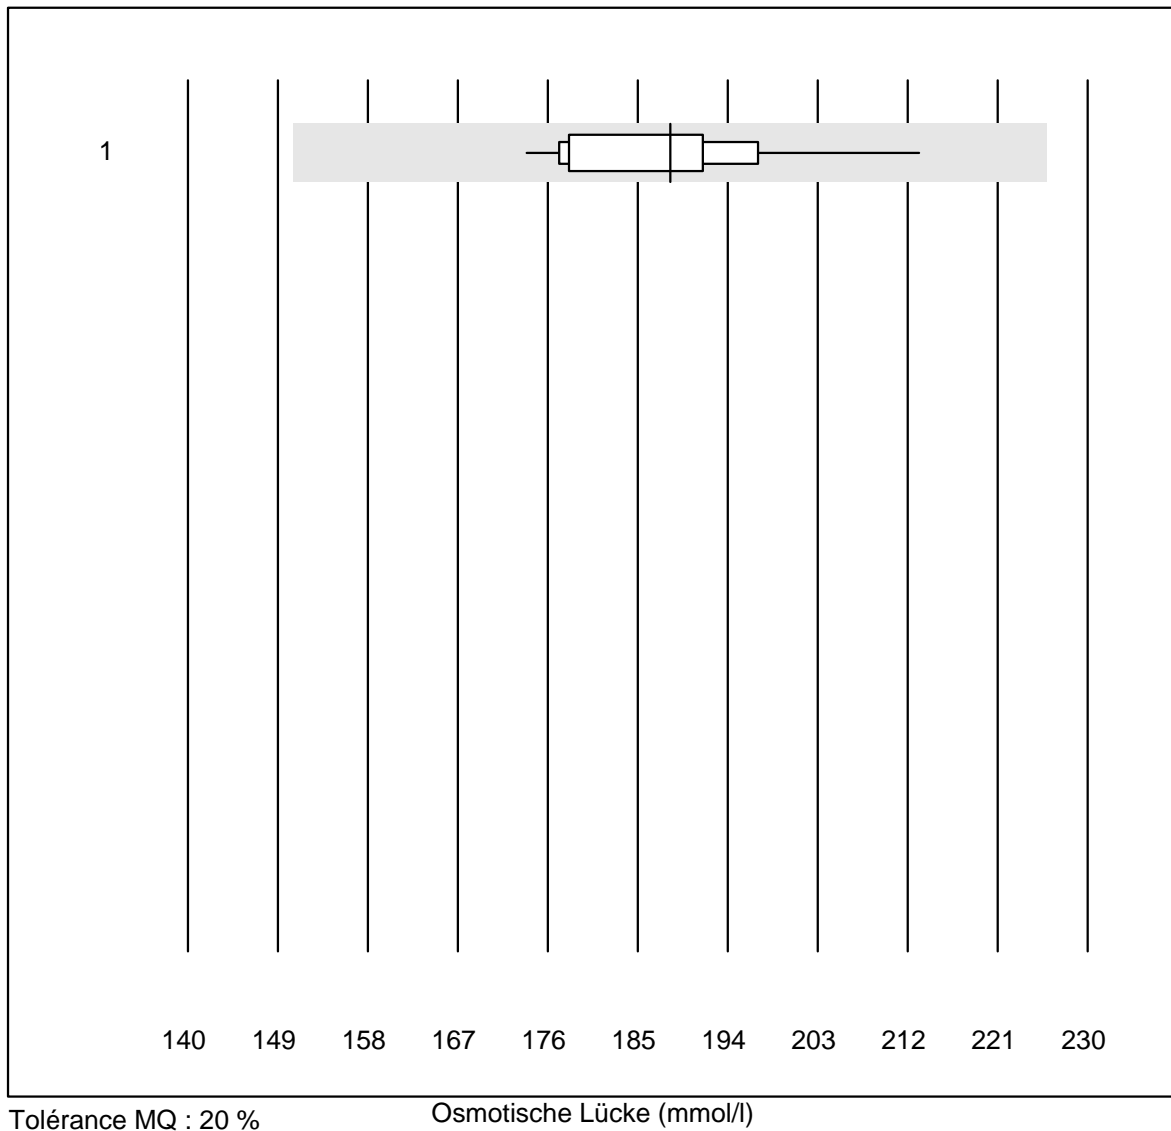

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Formel 1 (2Na+K+Glu+	11	100.0	0.0	0.0	188.3	5.7	e

# Digoxin

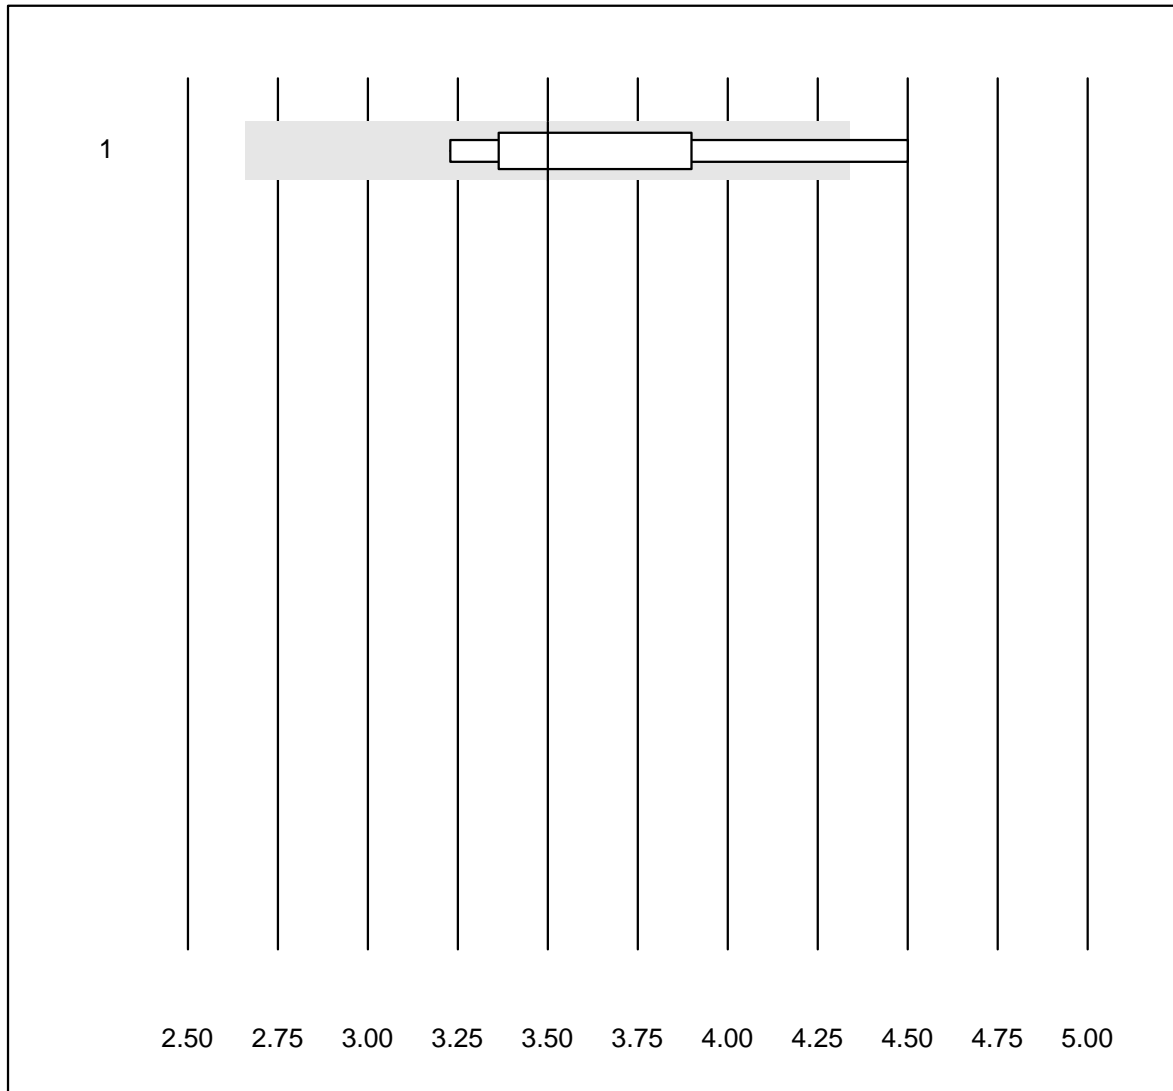


QUALAB Toleranz : 24 %

Digoxin (nmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Autres méthodes	9	77.8	11.1	11.1	3.50	11.5	e*



# Paracetamol

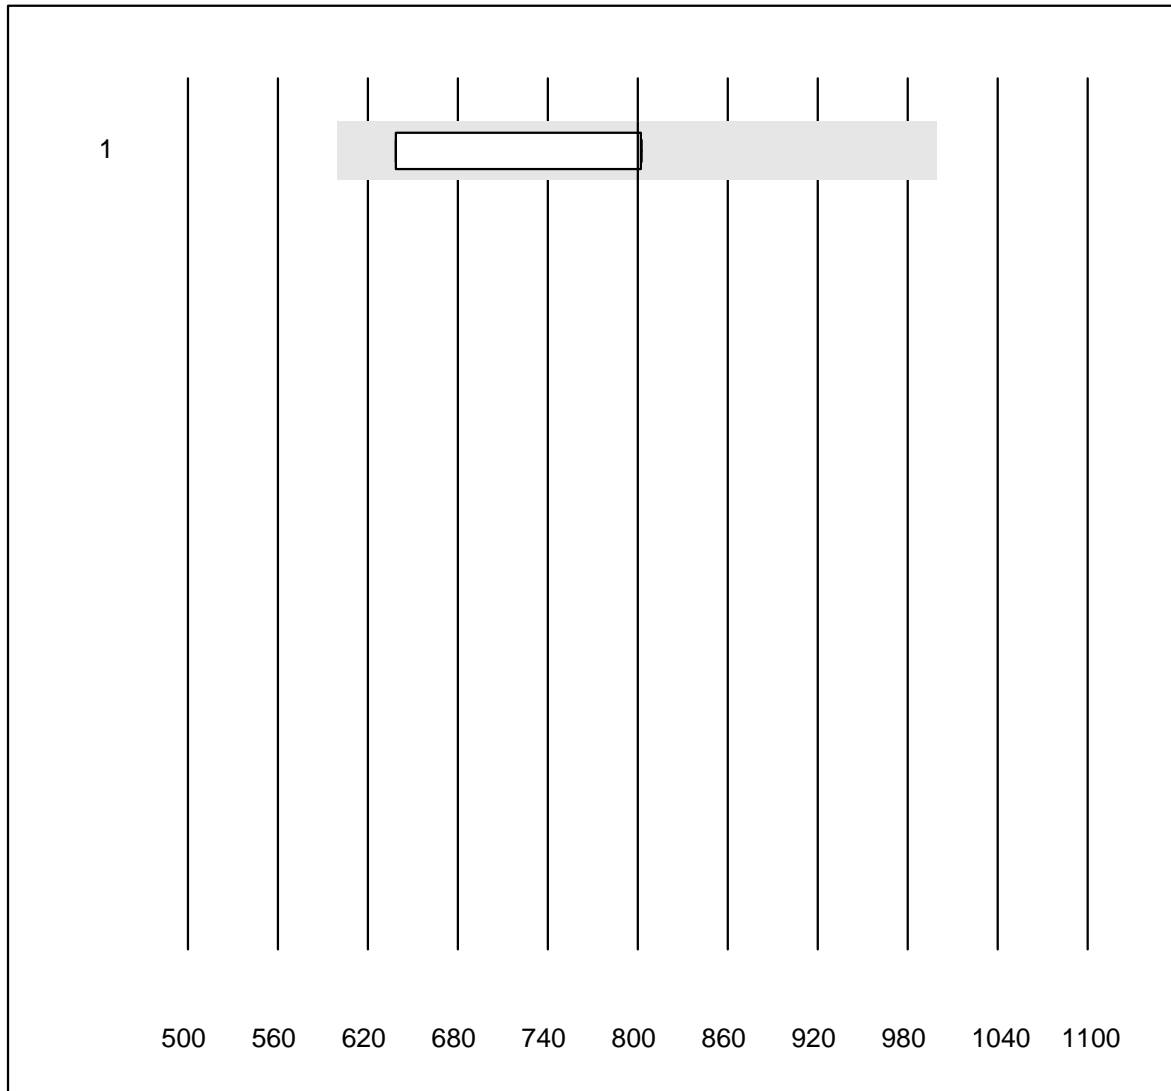


Tolérance MQ : 25 %

Paracetamol (µmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	799.8	10.7	e*

## Valproat

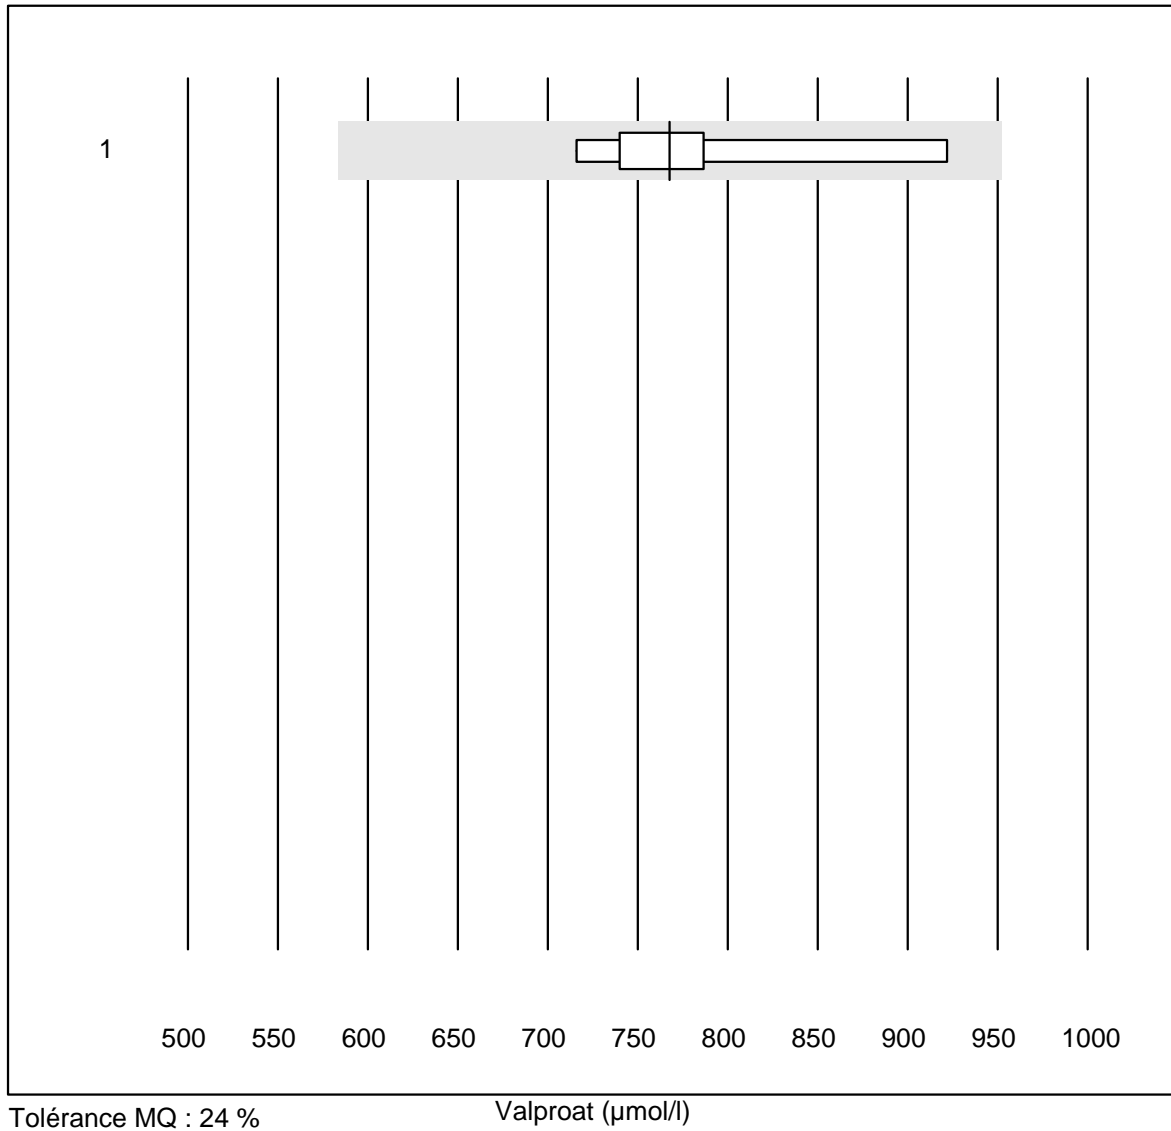

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	767.7	9.2	e*

## Cystatin C

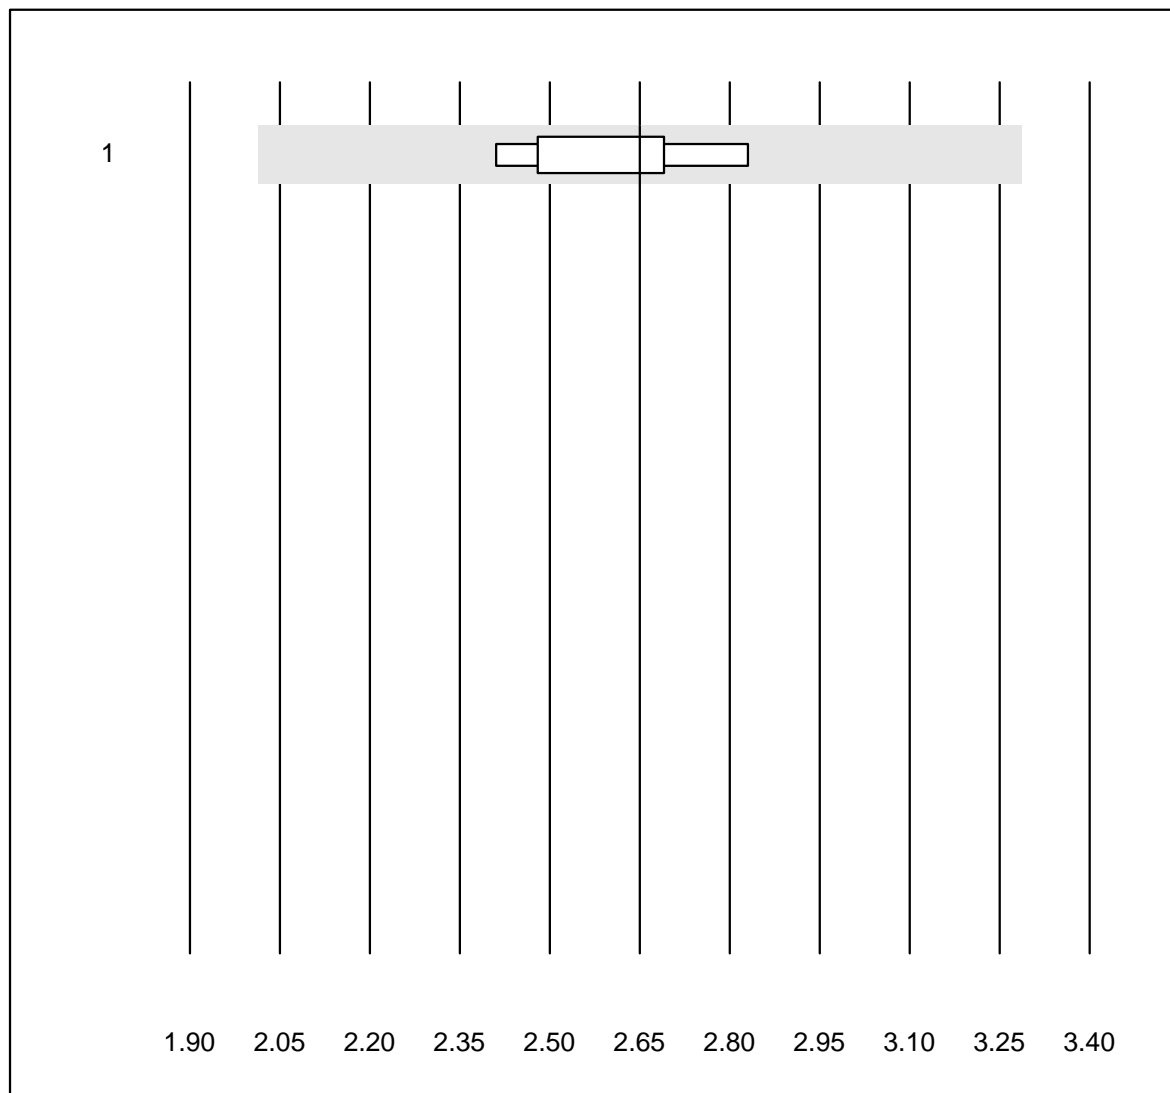


Tolérance MQ : 24 %

Cystatin C (mg/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	9	100.0	0.0	0.0	2.7	5.5	e

# Éthanol

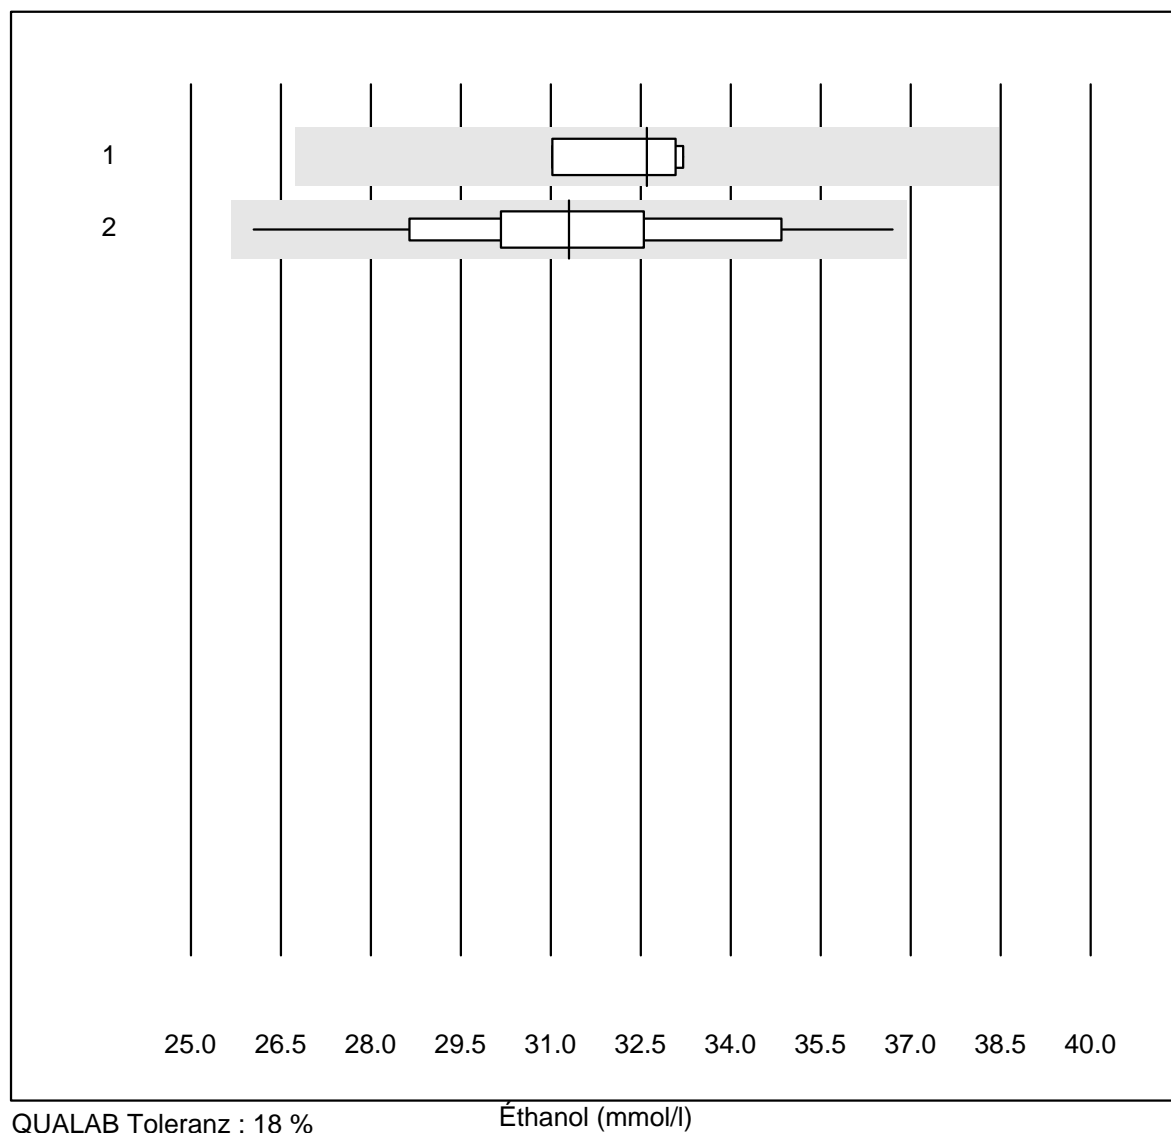

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Andere	4	100.0	0.0	0.0	32.6	3.1	e
2 toutes les méthodes	23	91.3	0.0	8.7	31.3	8.3	e

## Calprotectine

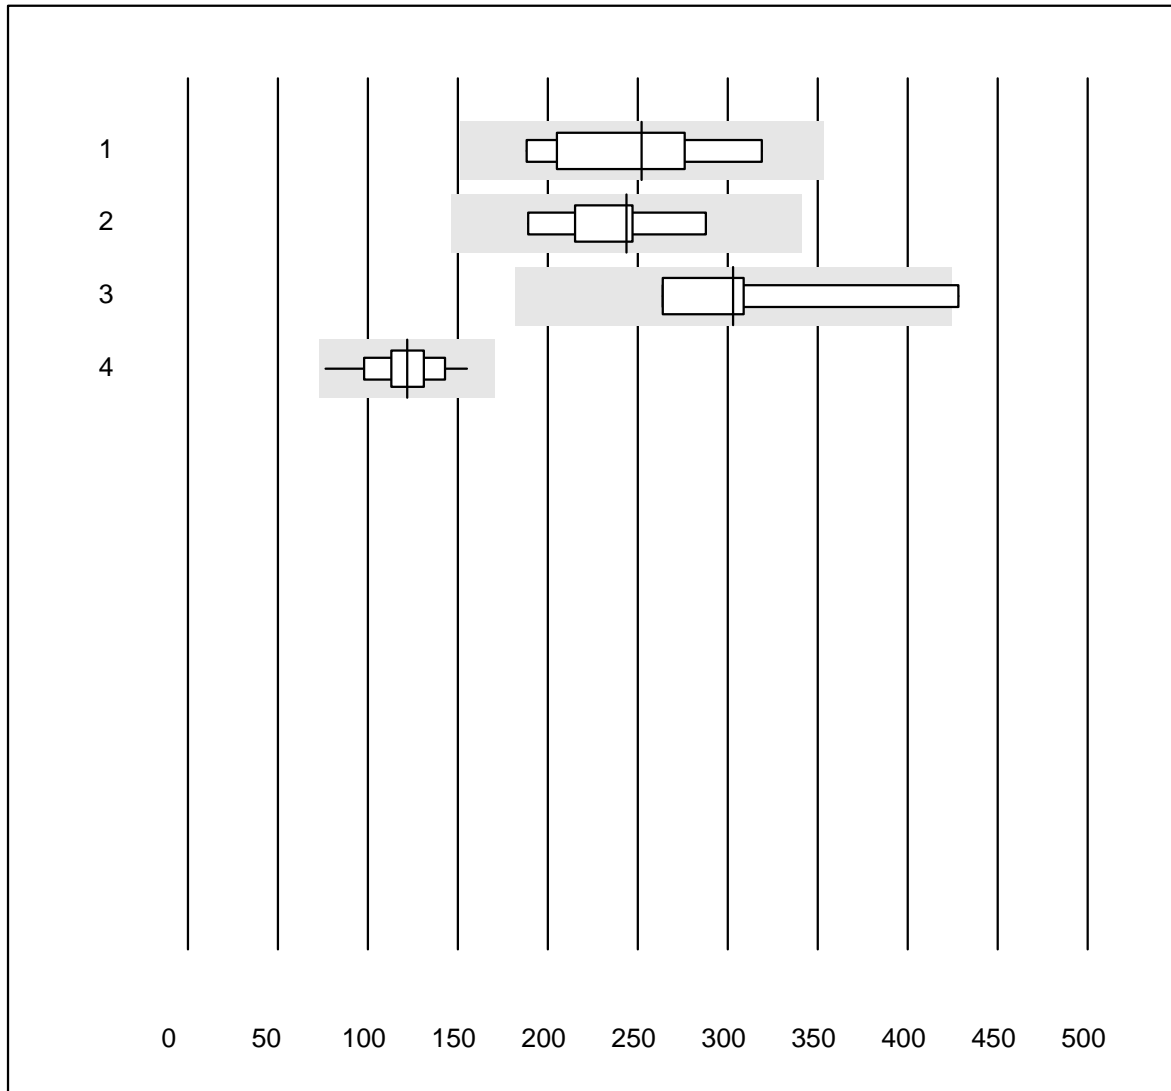


Tolérance MQ : 40 %

Calprotectine (µg/g)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Bühlmann ELISA	7	100.0	0.0	0.0	252	19.2	e*
2	Bühlmann fCALturbo	8	100.0	0.0	0.0	244	12.7	e
3	Bühlmann Quantum Blu	4	75.0	25.0	0.0	303	22.1	e*
4	Liaison	24	100.0	0.0	0.0	122	15.4	e

## Cholestérol Af/b101

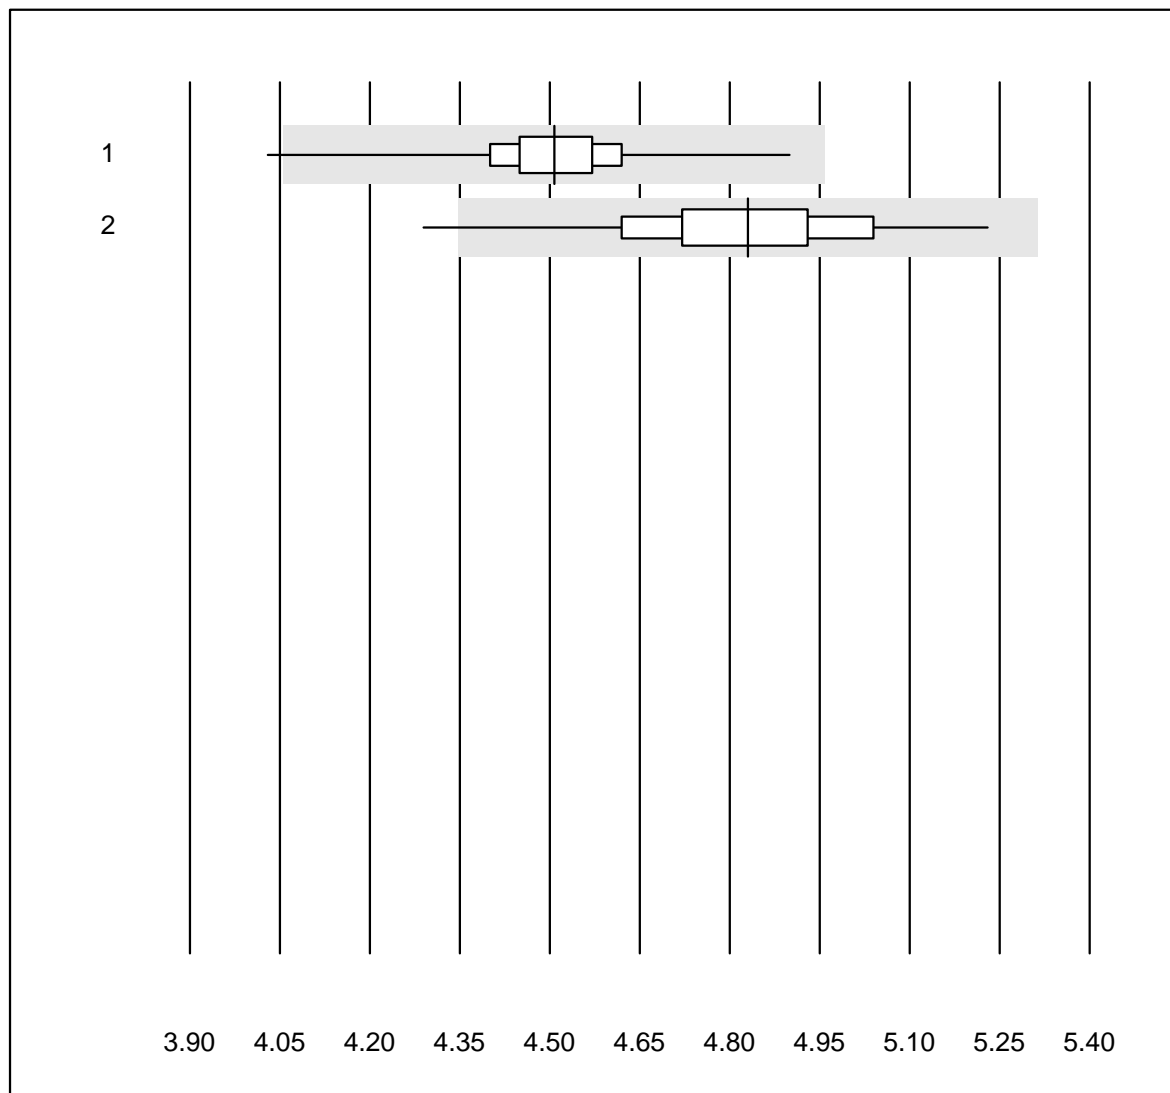


QUALAB Toleranz : 10 %

Cholestérol Af/b101 (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas b101	169	97.6	0.6	1.8	4.51	2.2	e
2 Afinion	452	99.6	0.2	0.2	4.83	3.4	e

## Cholestérol HDL Af/b101

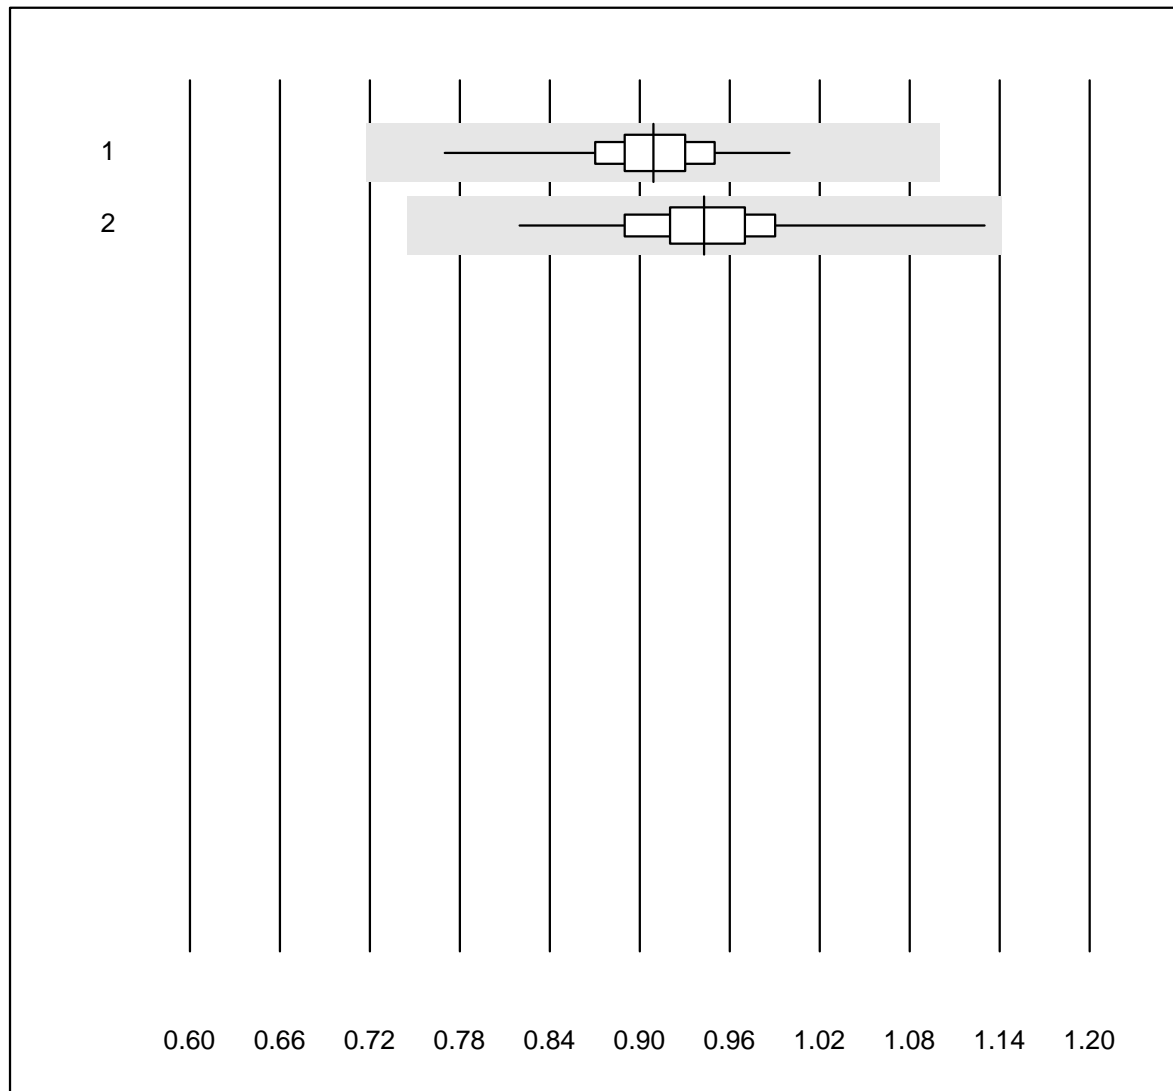


QUALAB Toleranz : 21 %

Cholestérol HDL Af/b101 (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas b101	168	94.0	0.0	6.0	0.91	3.7	e
2	Afinion	450	93.3	0.0	6.7	0.94	4.4	e

## Triglycerides Af/b101

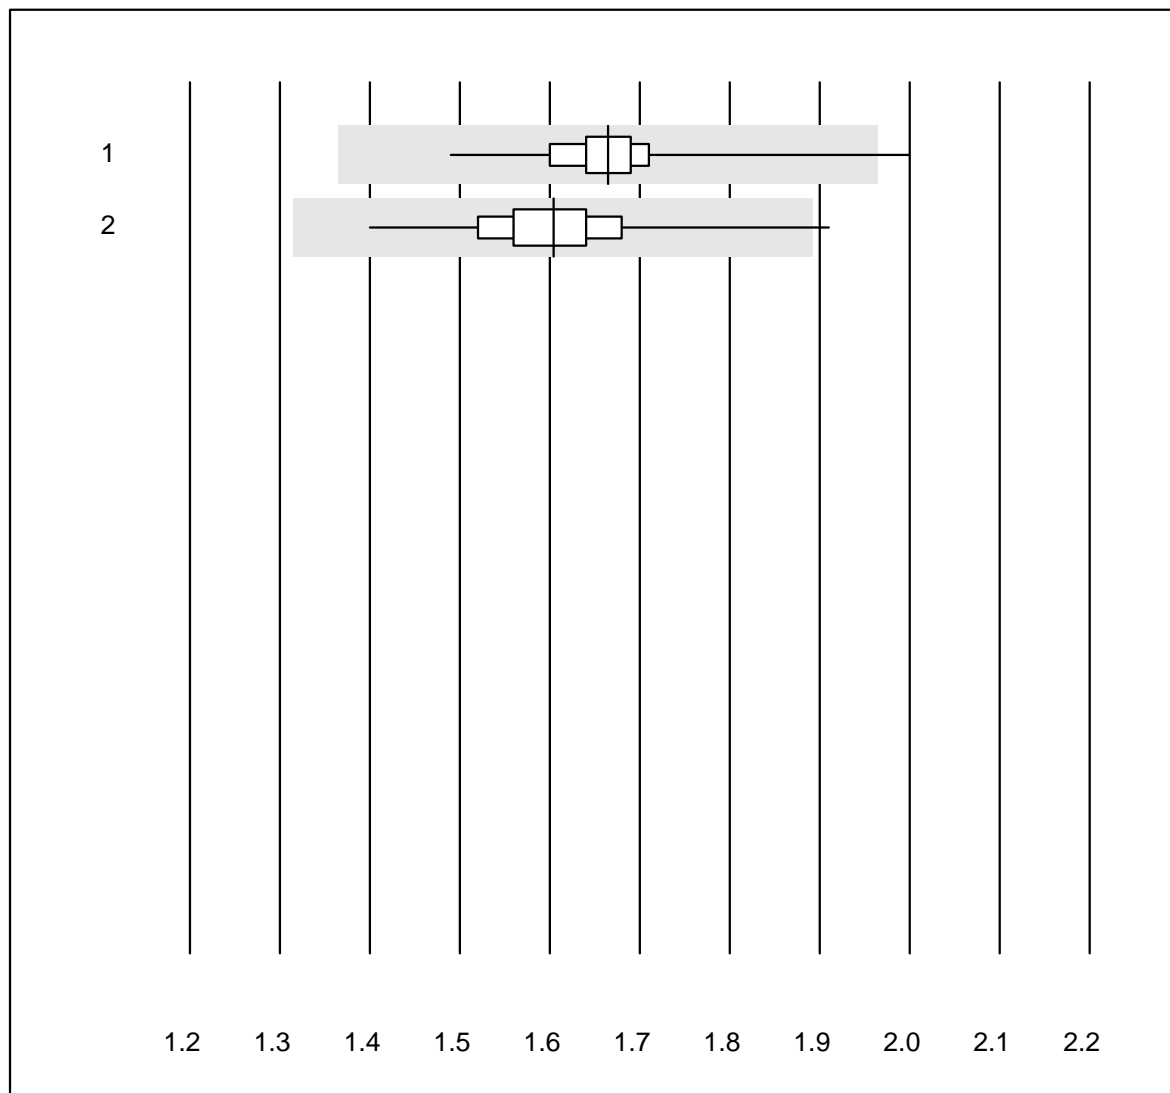


QUALAB Toleranz : 18 %

Triglycerides Af/b101 (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas b101	167	97.6	0.6	1.8	1.66	3.1	e
2 Afinion	451	99.6	0.2	0.2	1.60	4.0	e



## Troponine I S

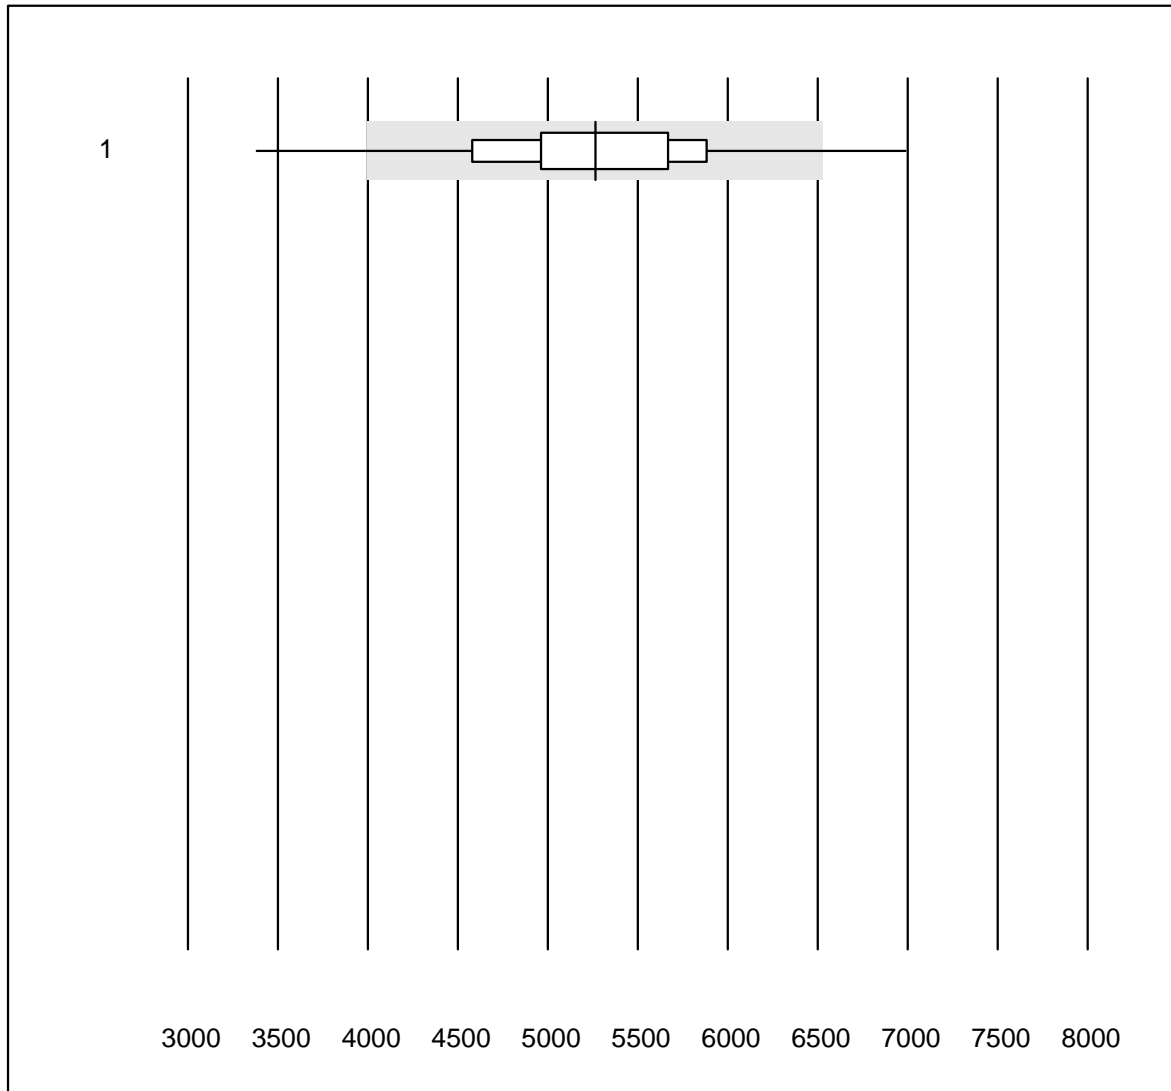


QUALAB Toleranz : 24 %

Troponine I S (ng/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 AFIAS	156	87.2	6.4	6.4	5264.56	12.0	e

## D-Dimères qn S

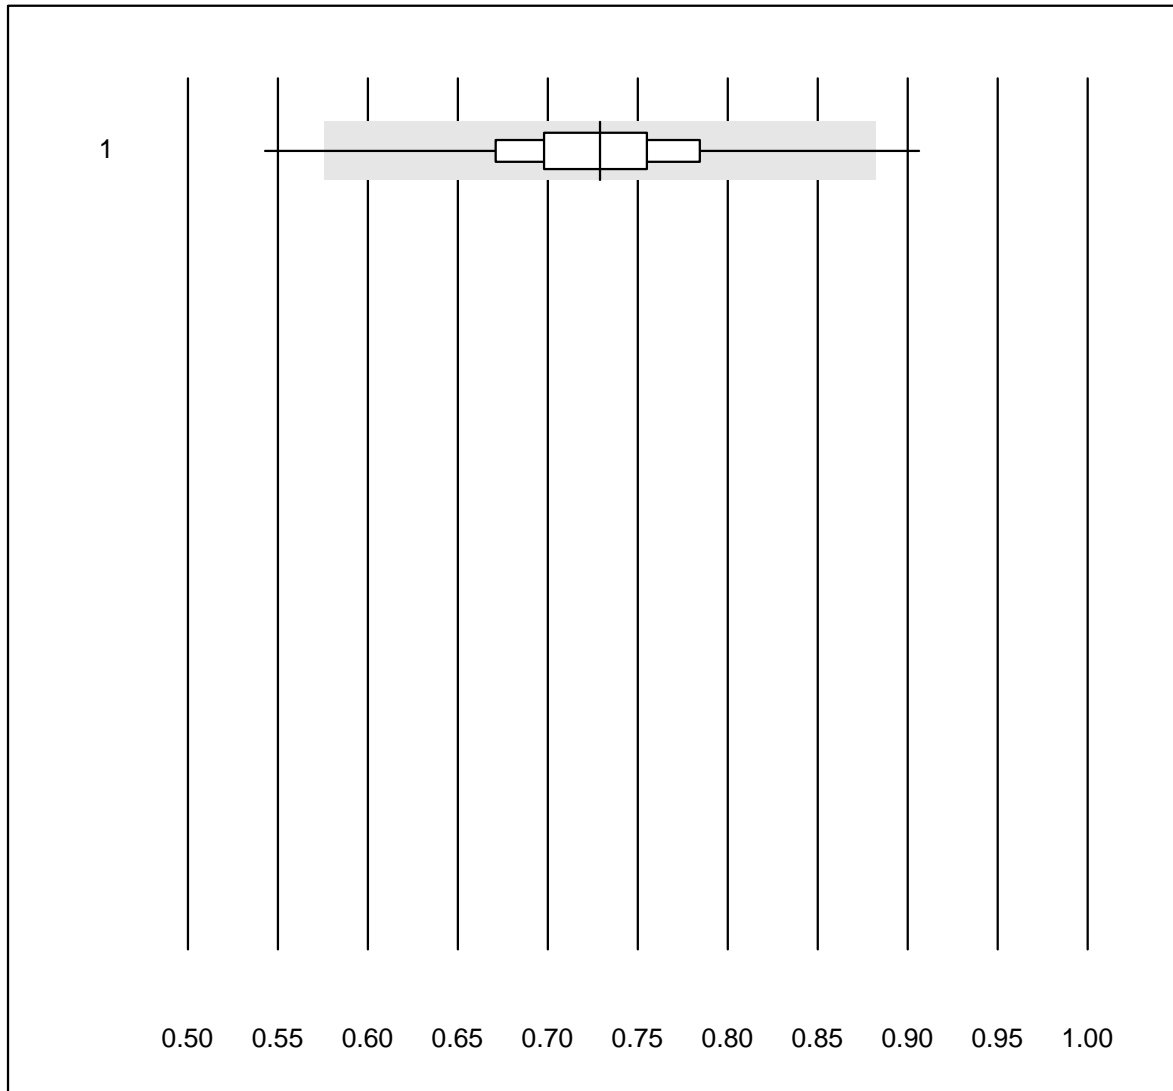


QUALAB Toleranz : 21 %

D-Dimères qn S (mg/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 AFIAS	160	91.2	2.5	6.3	0.73	6.8	e

## NT-proBNP S

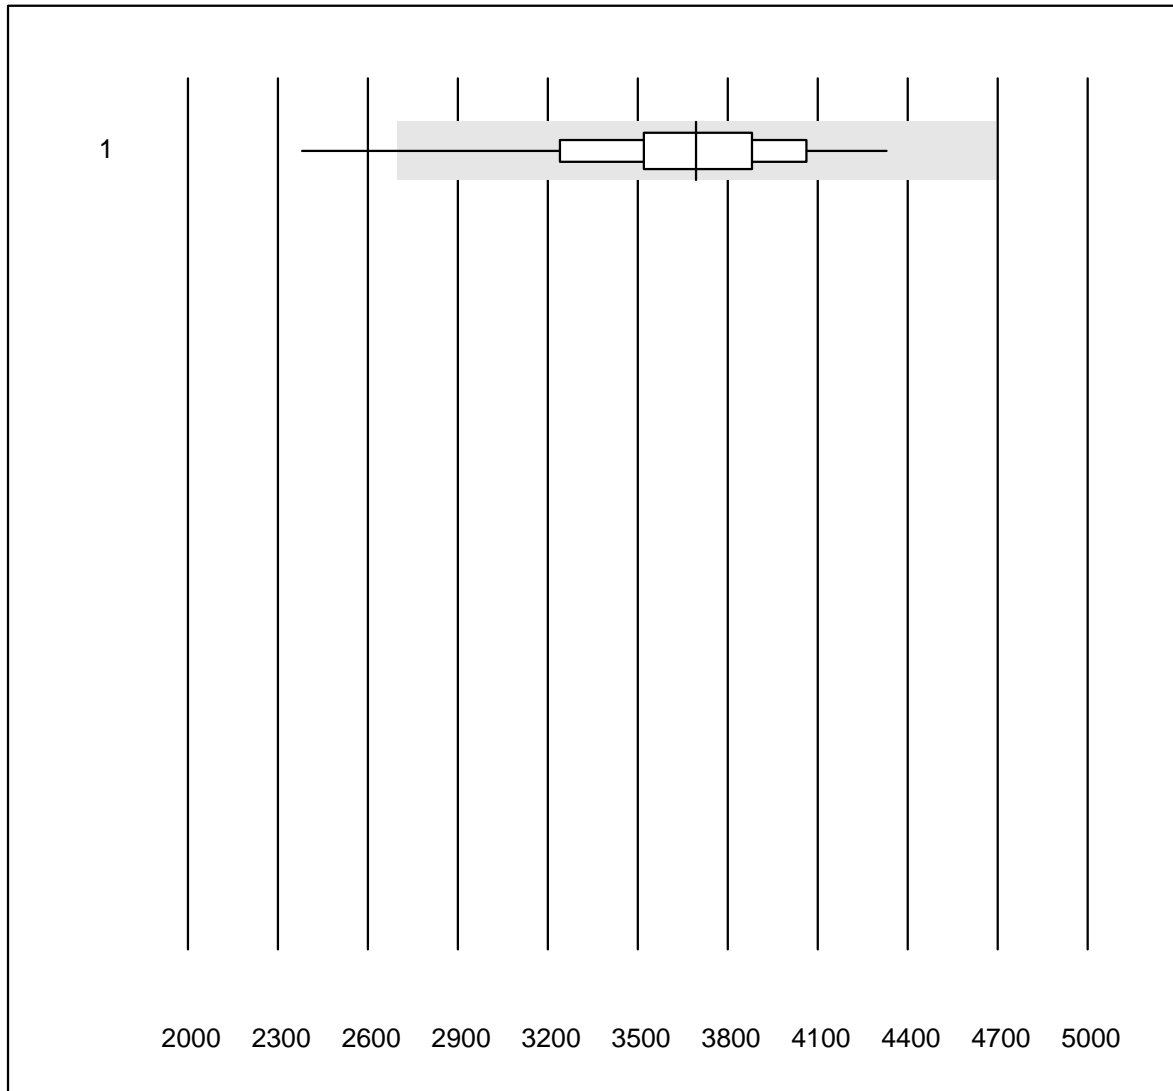


QUALAB Toleranz : 27 %

NT-proBNP S (ng/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 AFIAS	120	99.2	0.8	0.0	3694.6	8.4	e

# Homocystein

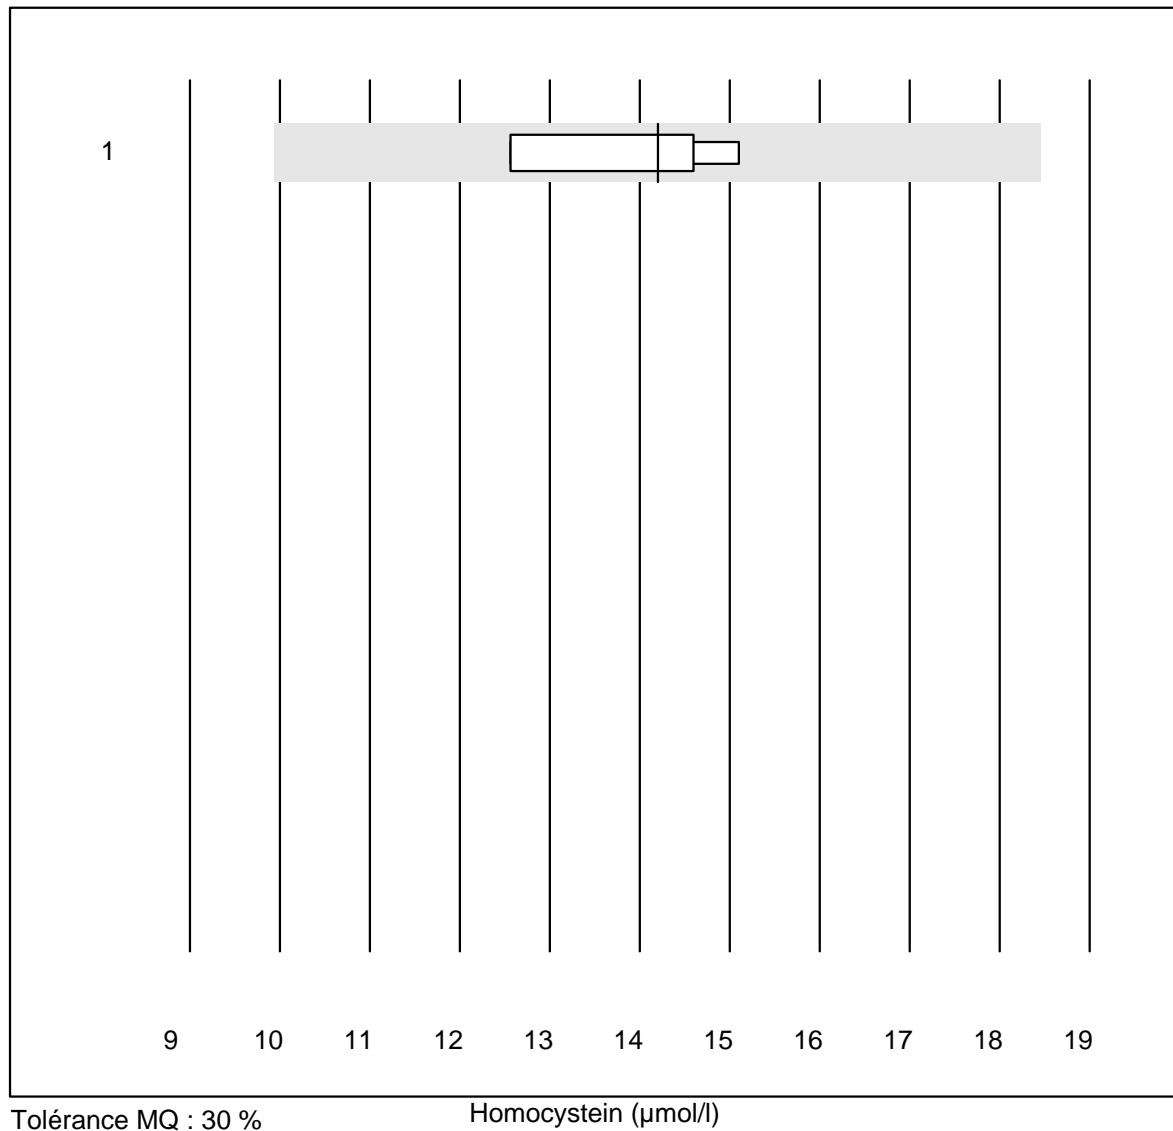


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	14.2	7.9	e*

# Lipase

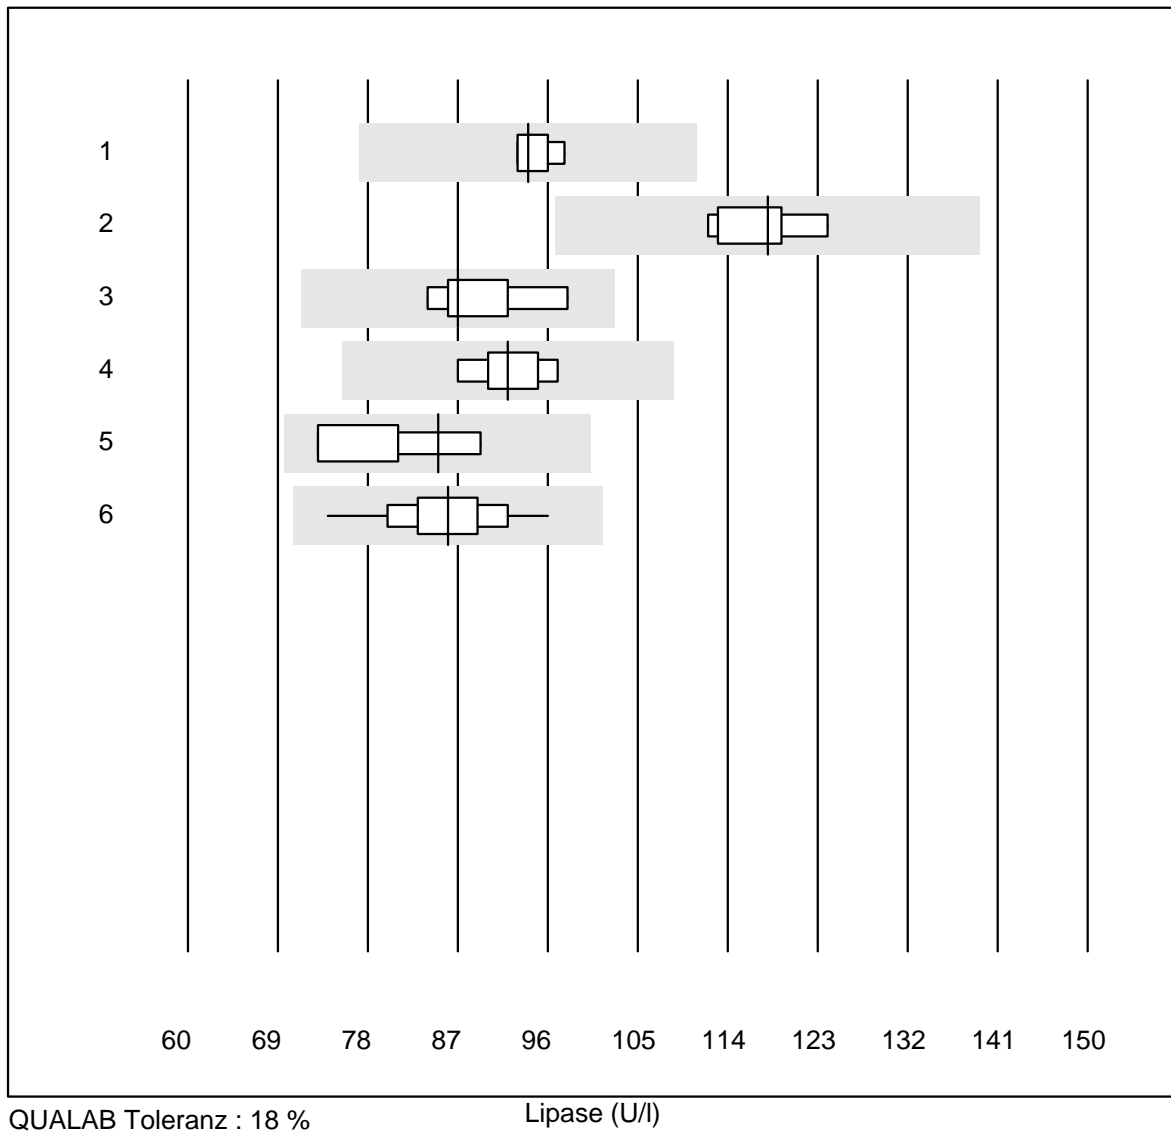


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Roche	5	100.0	0.0	0.0	94.0	2.2	e
2	Siemens Advia	5	100.0	0.0	0.0	118.0	4.2	e
3	Architect	5	100.0	0.0	0.0	87.0	6.3	e*
4	Beckman	9	100.0	0.0	0.0	92.0	3.9	e
5	Cobas	4	100.0	0.0	0.0	85.0	9.3	a
6	Fuji Dri-Chem	144	99.3	0.0	0.7	86.0	4.9	e

# Cholinestérase

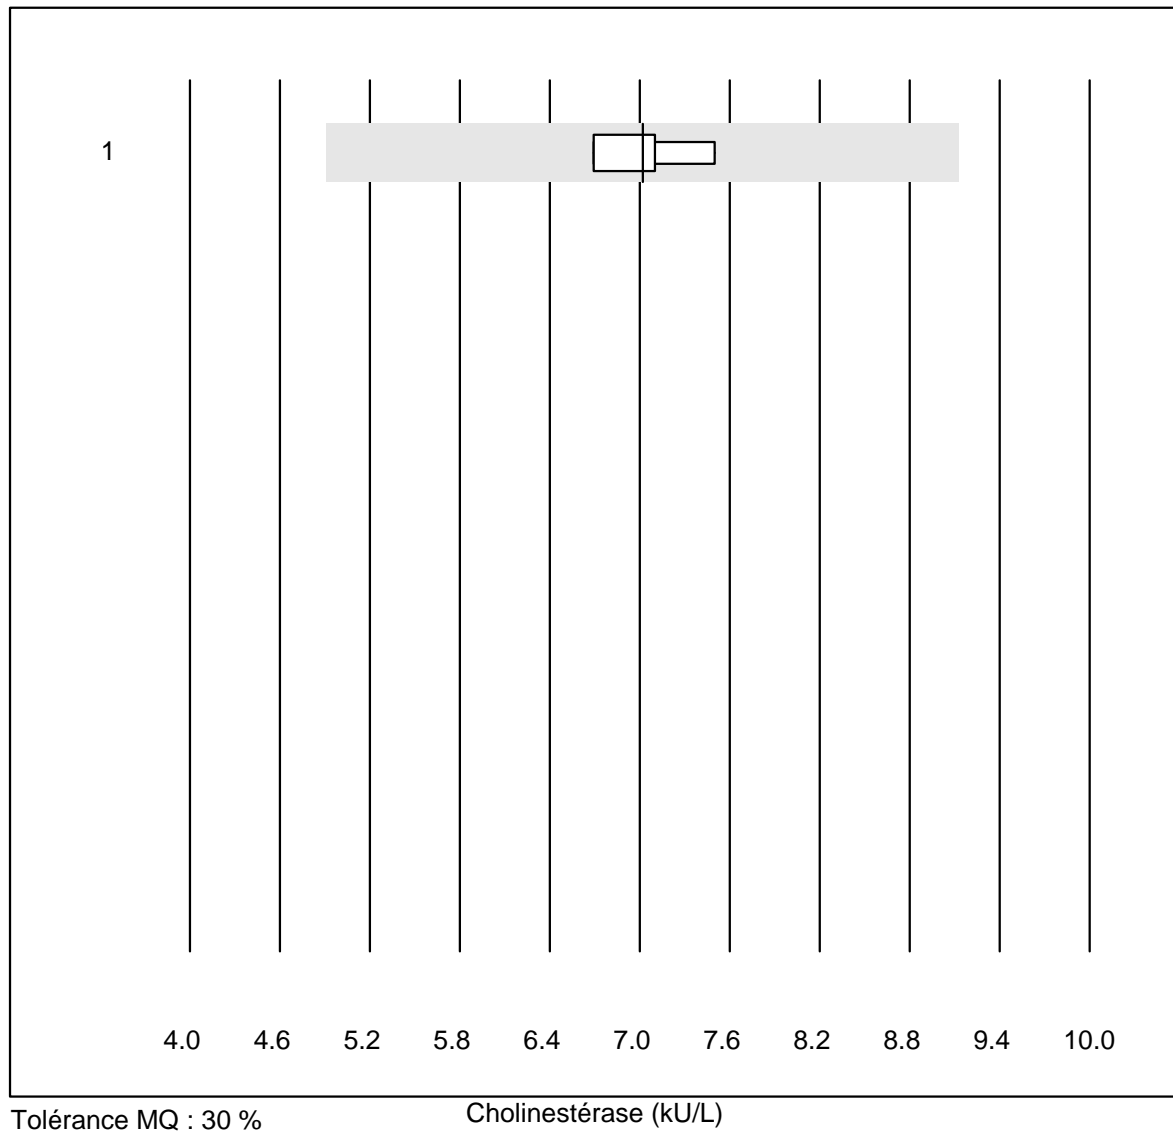

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	7.0	4.8	e

## Glucose CSF

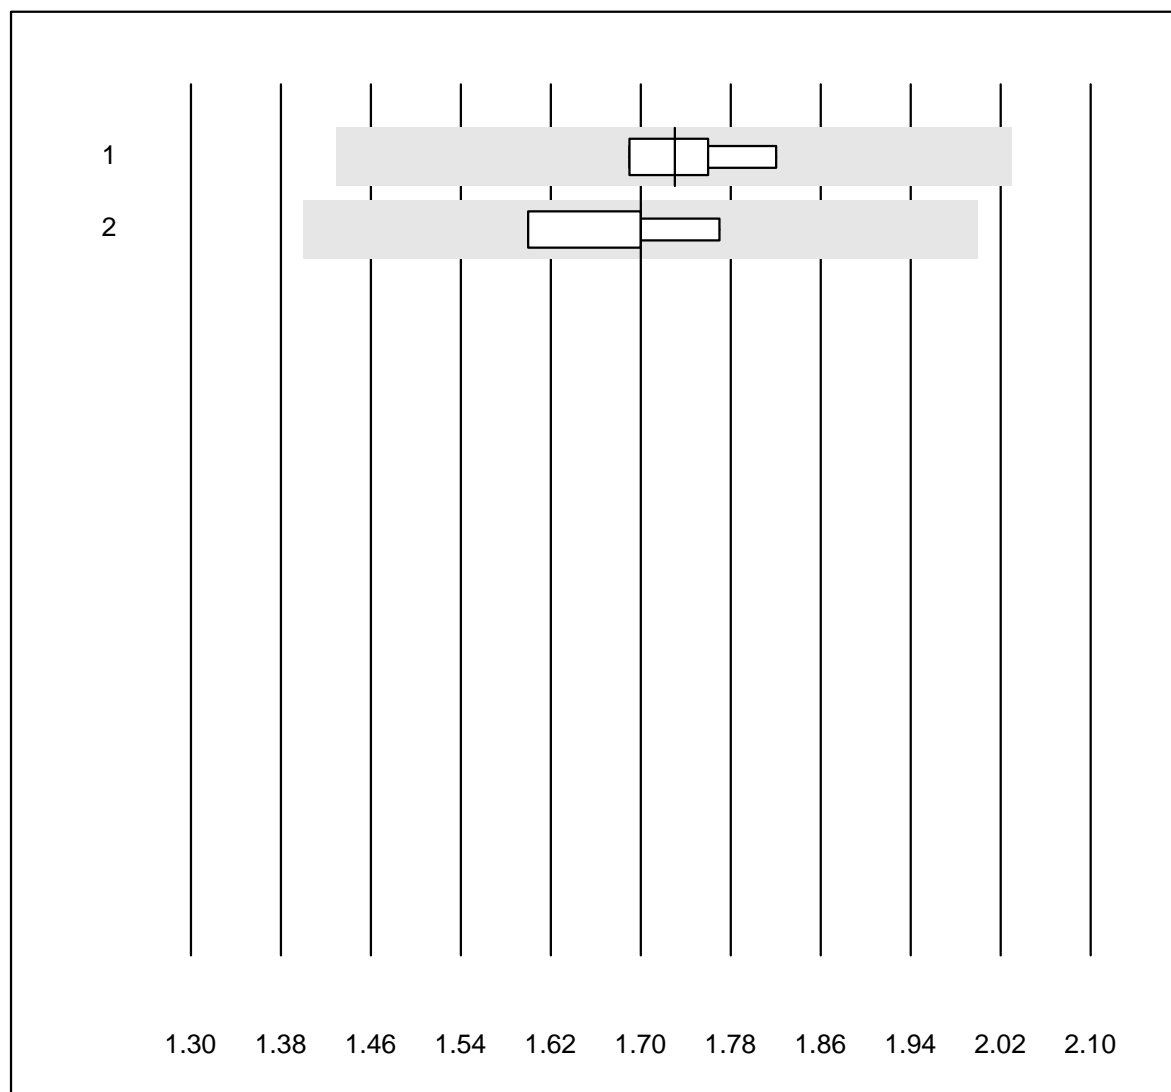


QUALAB Toleranz : 9 %  
( < 3.30: +/- 0.30 mmol/l)

Glucose CSF (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	1.73	3.5	e*
2 Autres méthodes	8	100.0	0.0	0.0	1.70	3.6	e*


## Lactate CSF

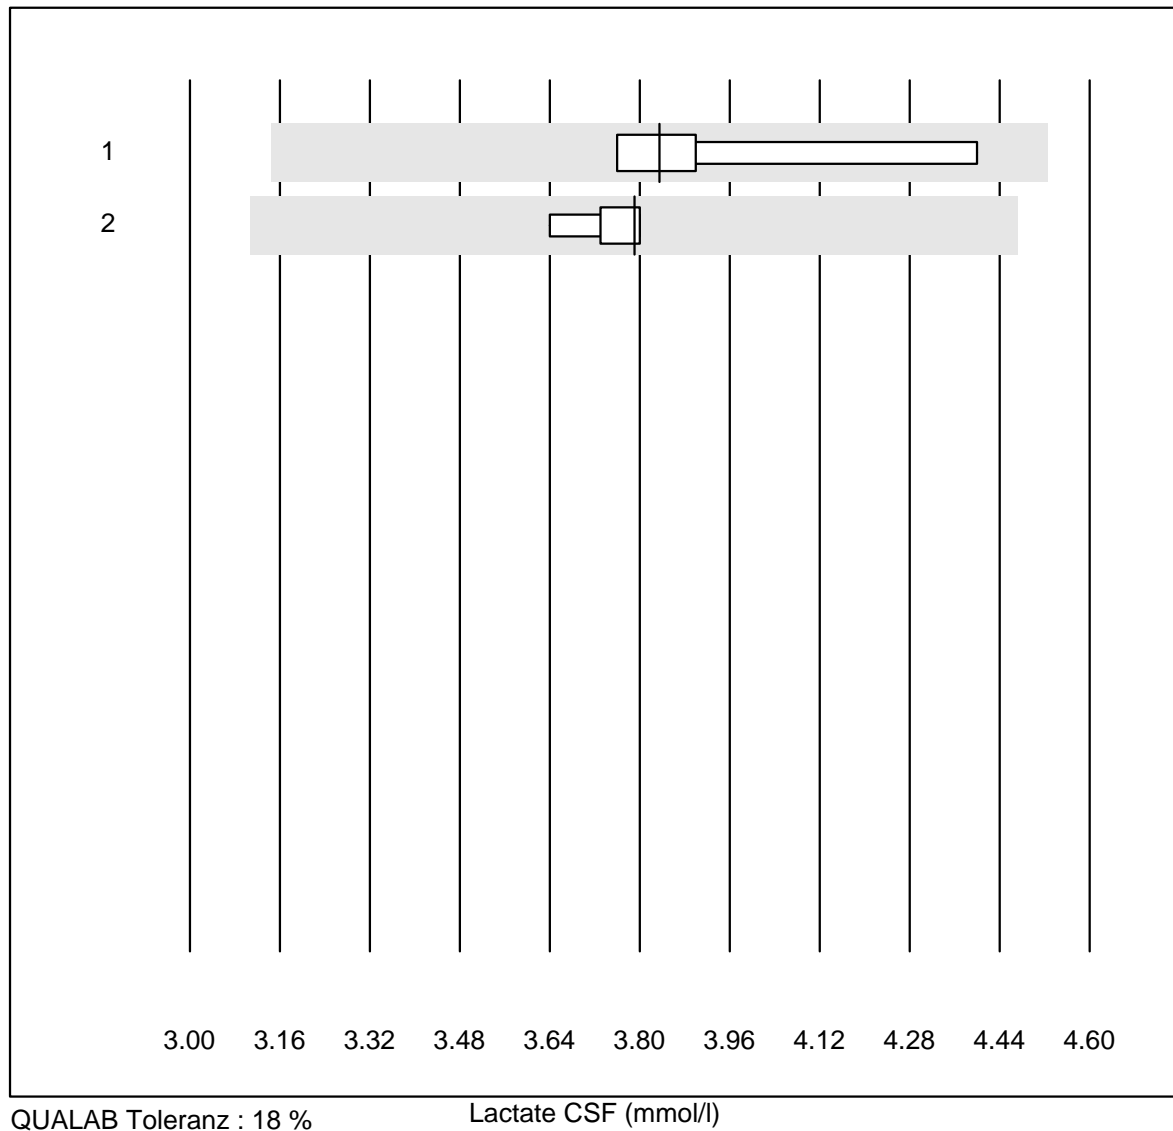

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	3.84	7.6	e*
2 Autres méthodes	6	100.0	0.0	0.0	3.79	1.7	e




## Protéine CSF

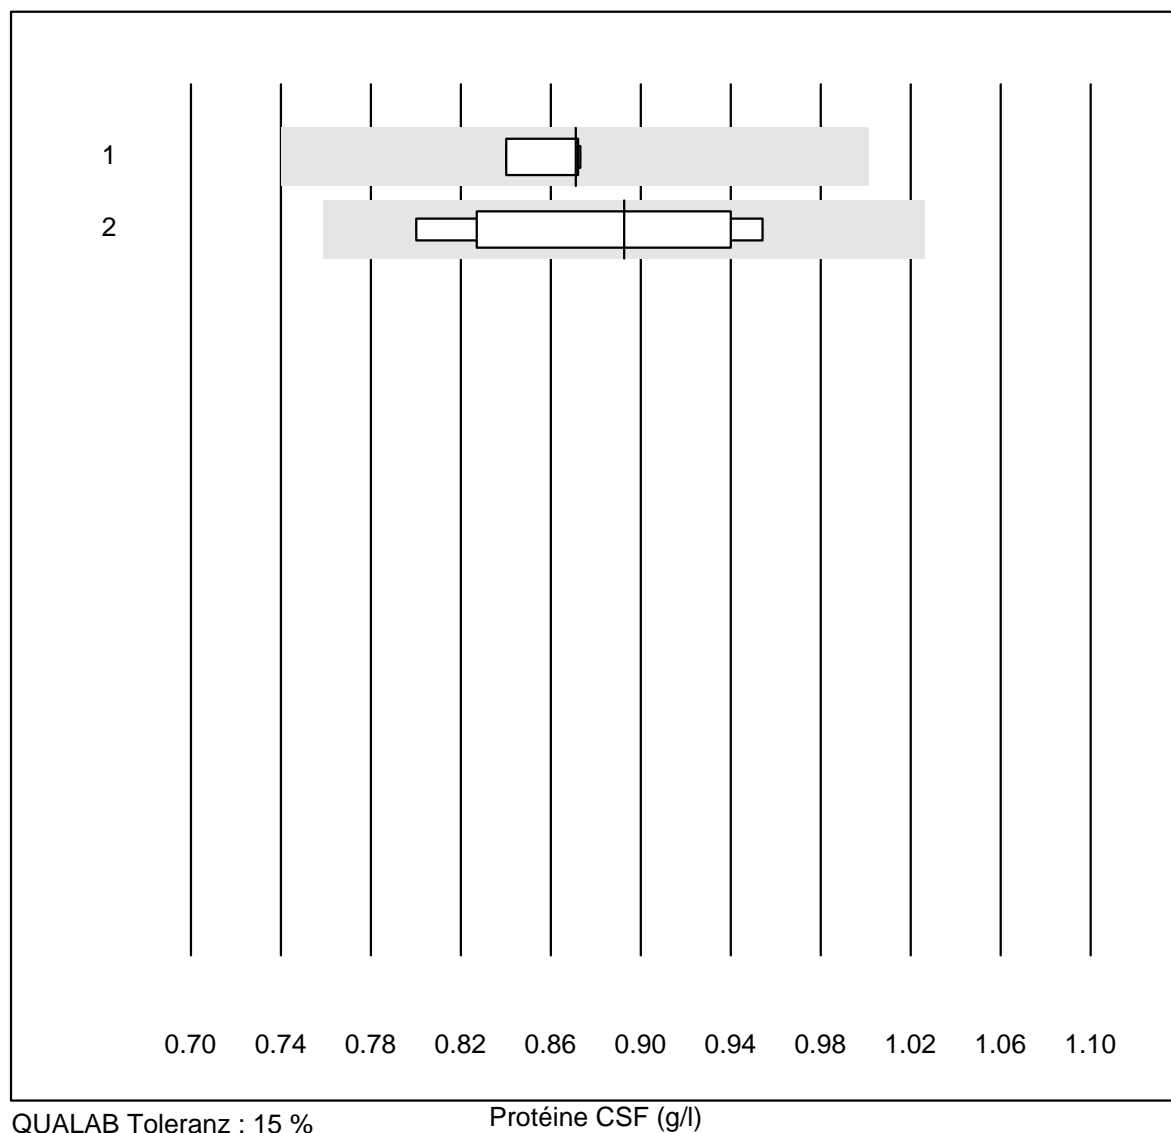


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	0.87	1.8	e
2 Autres méthodes	6	100.0	0.0	0.0	0.89	7.0	e*

## Tacrolimus

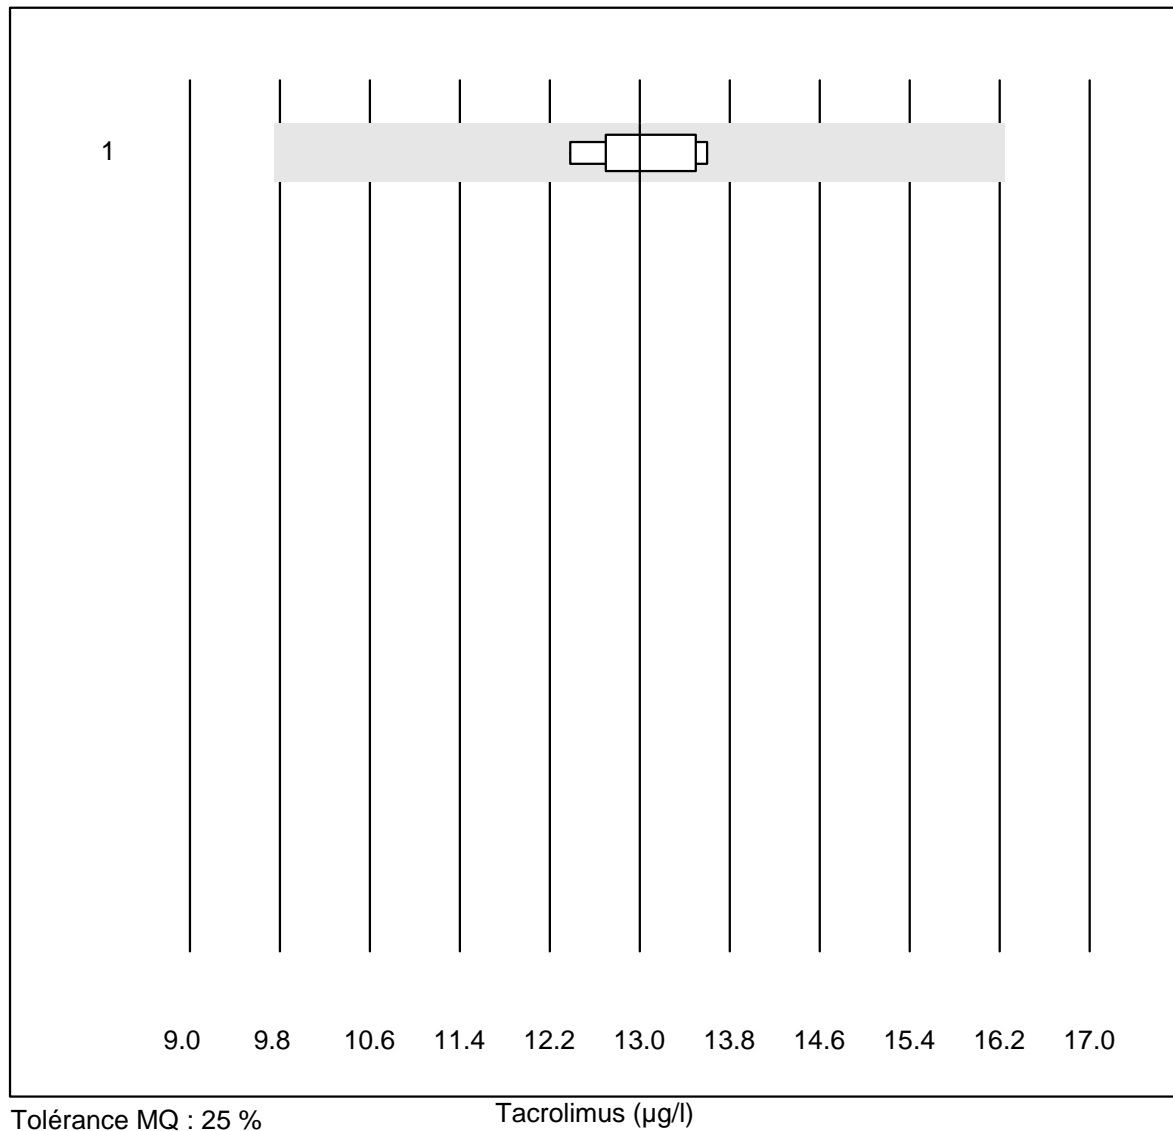

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	13.0	3.4	e

## Totalprotein E

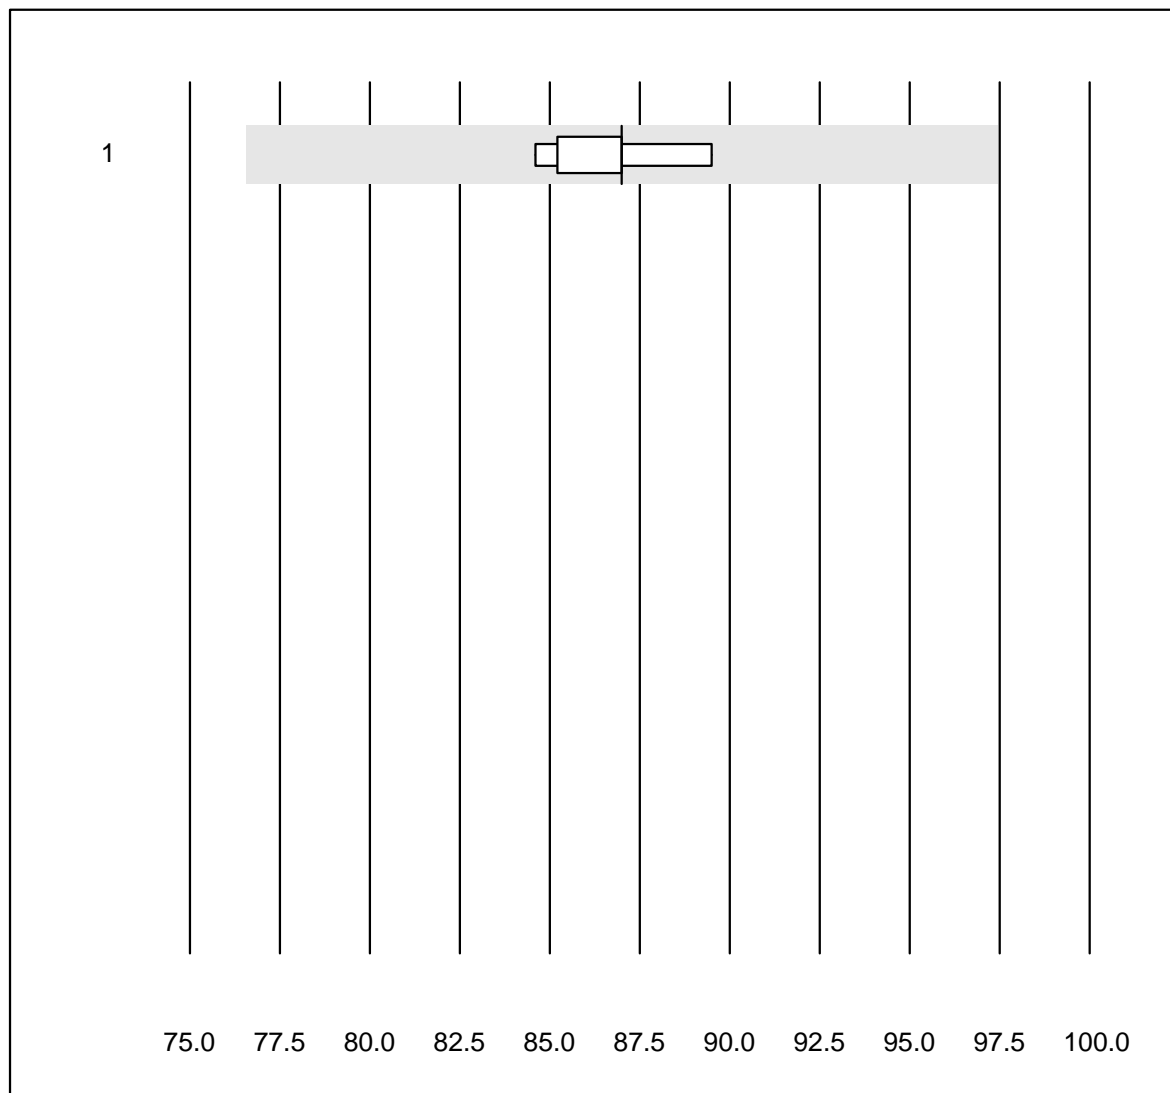


Tolérance MQ : 12 %

Totalprotein E (g/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	87.0	2.2	e

## Albumin E

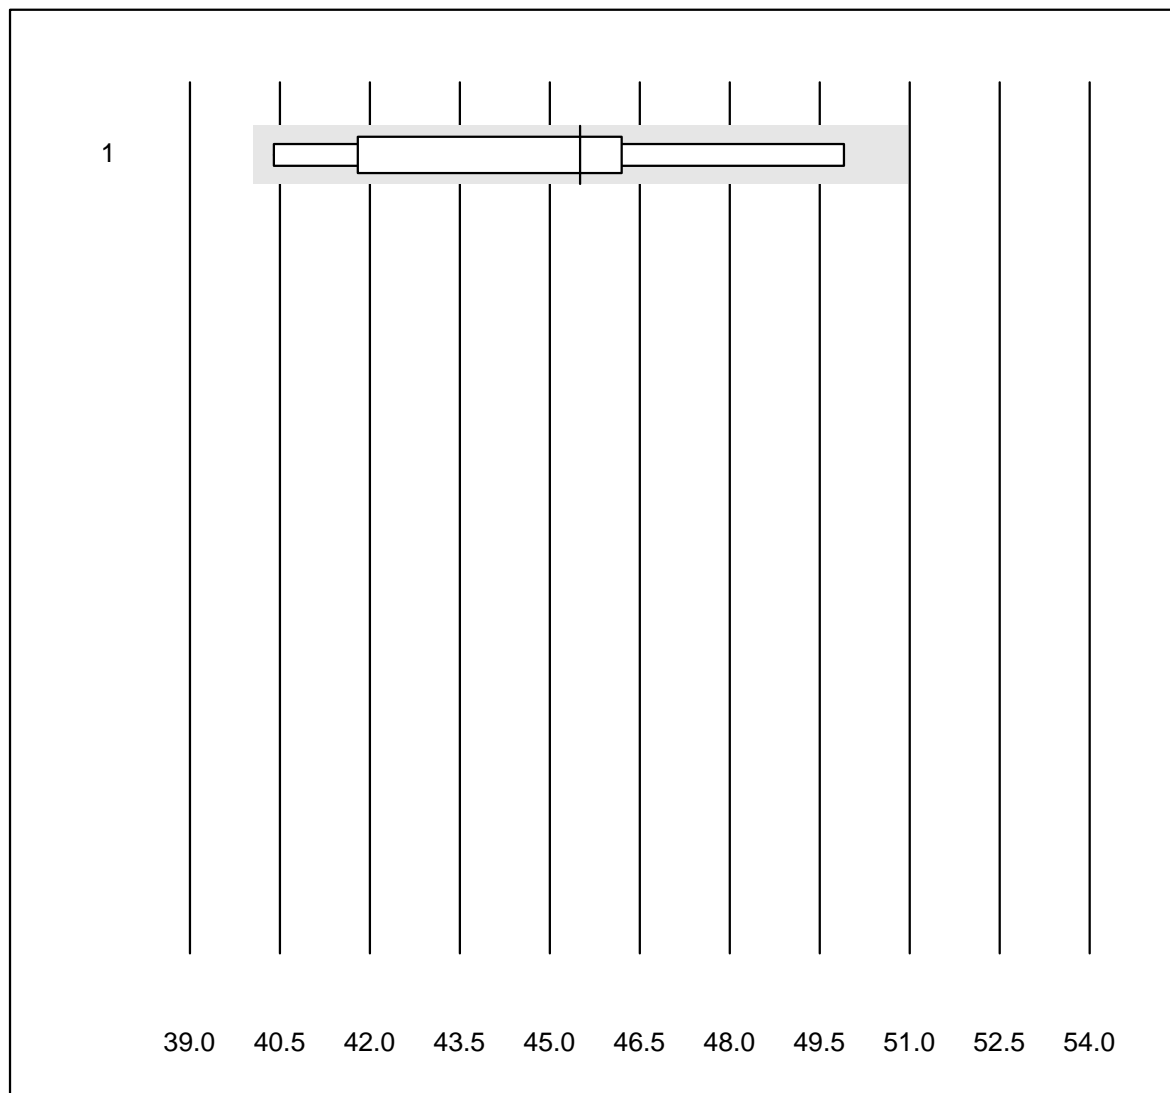


Tolérance MQ : 12 %

Albumin E (%)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 électrophorèse	9	100.0	0.0	0.0	45.5	7.8	a

## alpha-1-Globuline

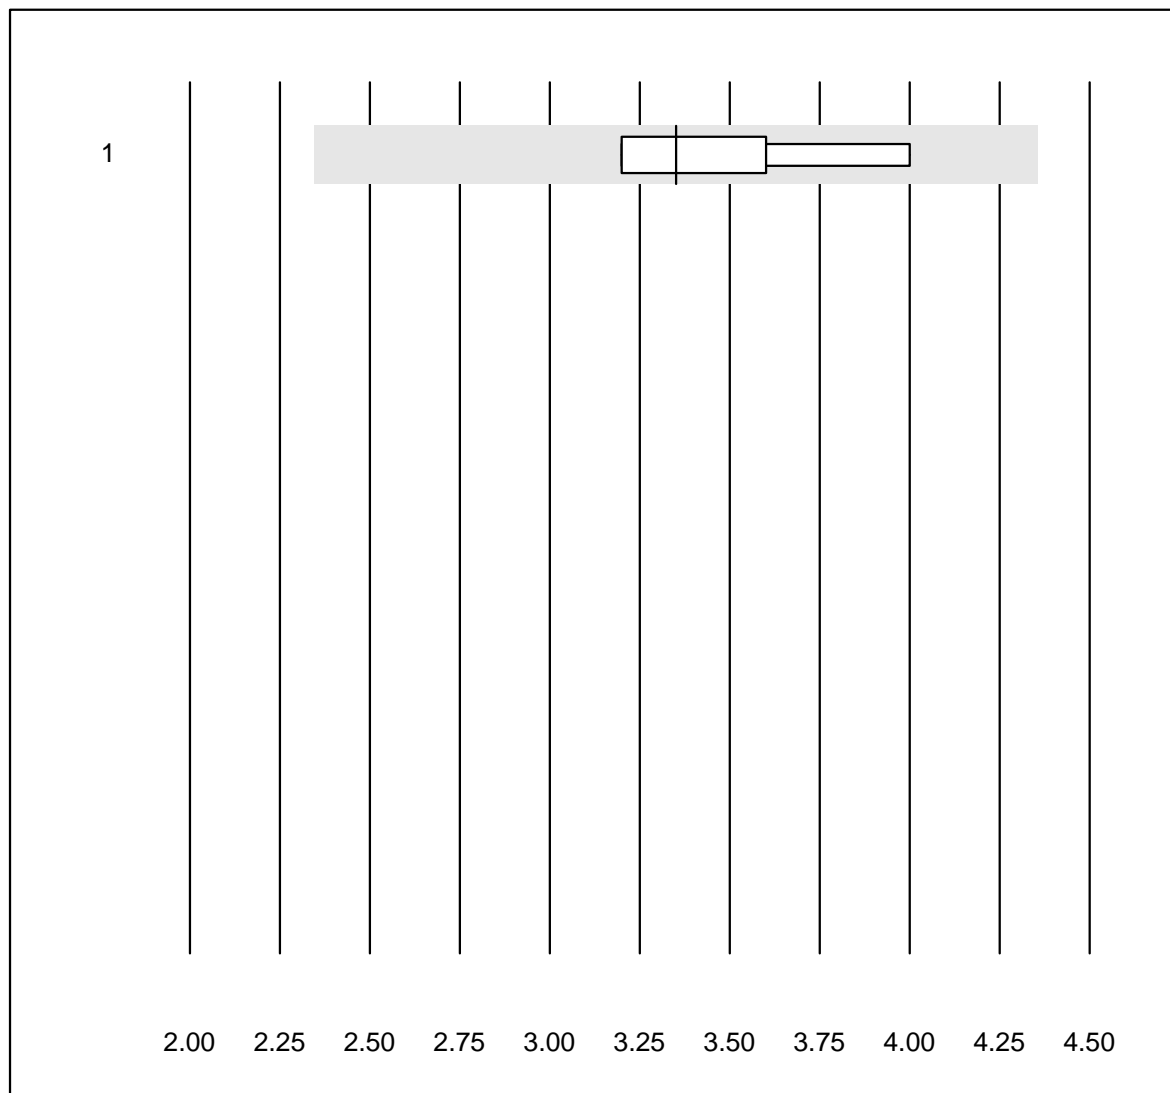


Tolérance MQ : 30 %

alpha-1-Globuline (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	électrophorèse capil	6	100.0	0.0	0.0	3.4	8.9	e*

## alpha-2-Globuline

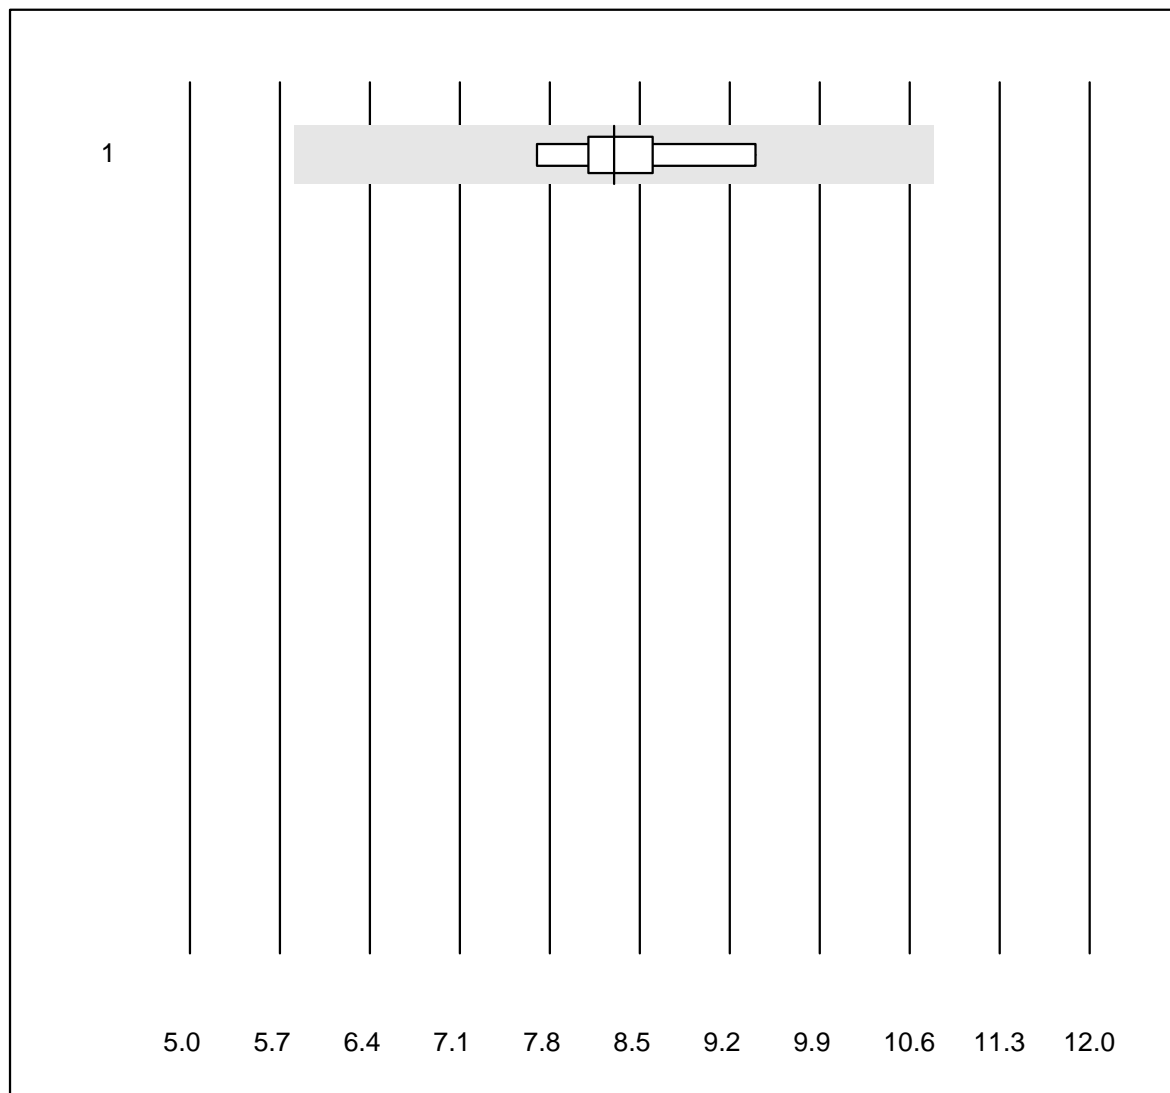


Tolérance MQ : 30 %

alpha-2-Globuline (%)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 électrophorèse	9	100.0	0.0	0.0	8.3	6.0	e

## beta-Globuline

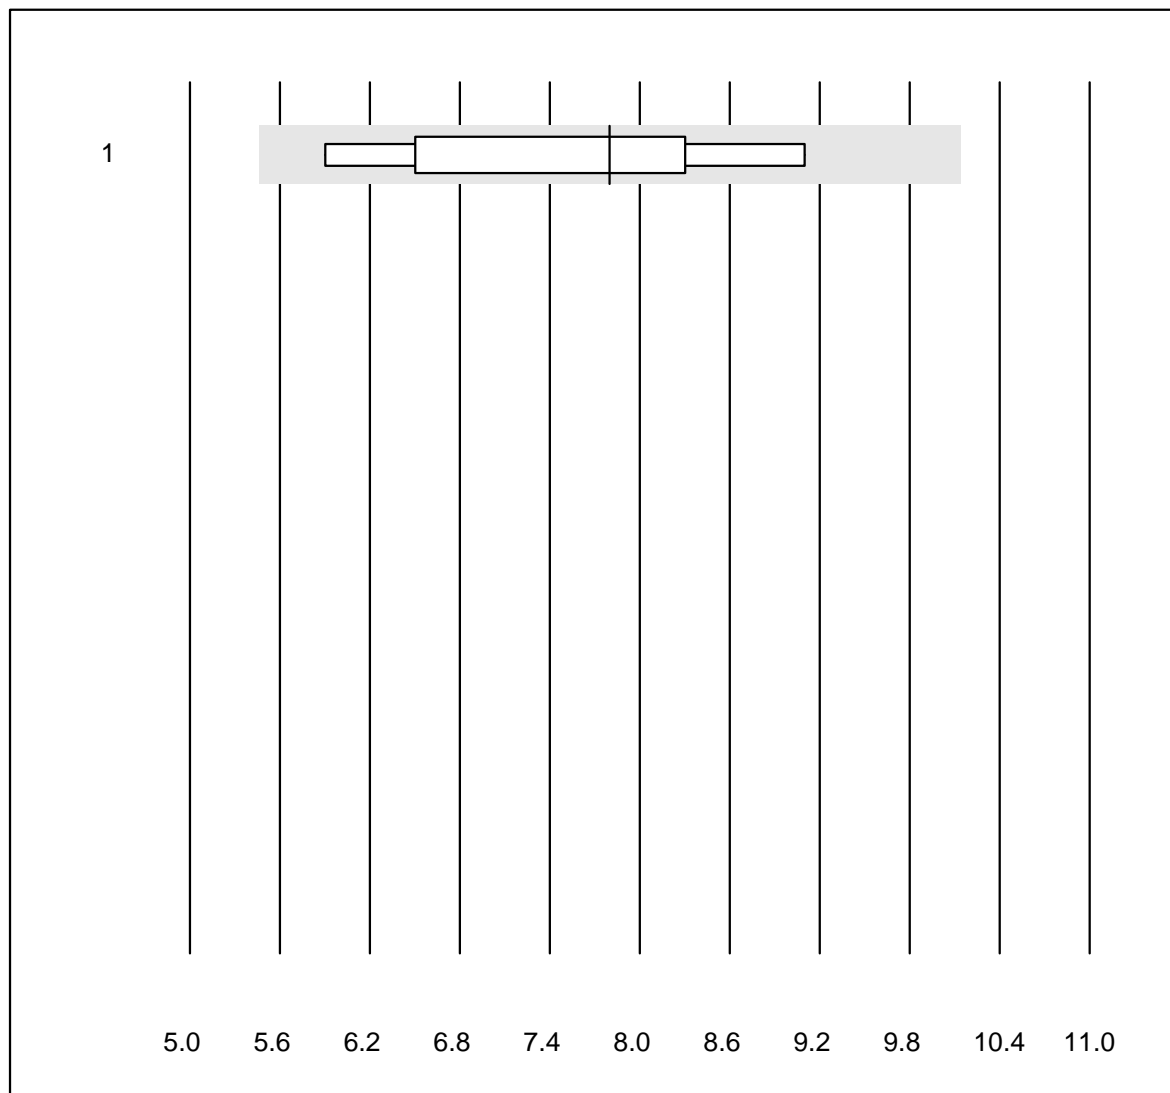


Tolérance MQ : 30 %

beta-Globuline (%)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 électrophorèse	7	100.0	0.0	0.0	7.8	15.3	e*

## Beta-1-Globulin

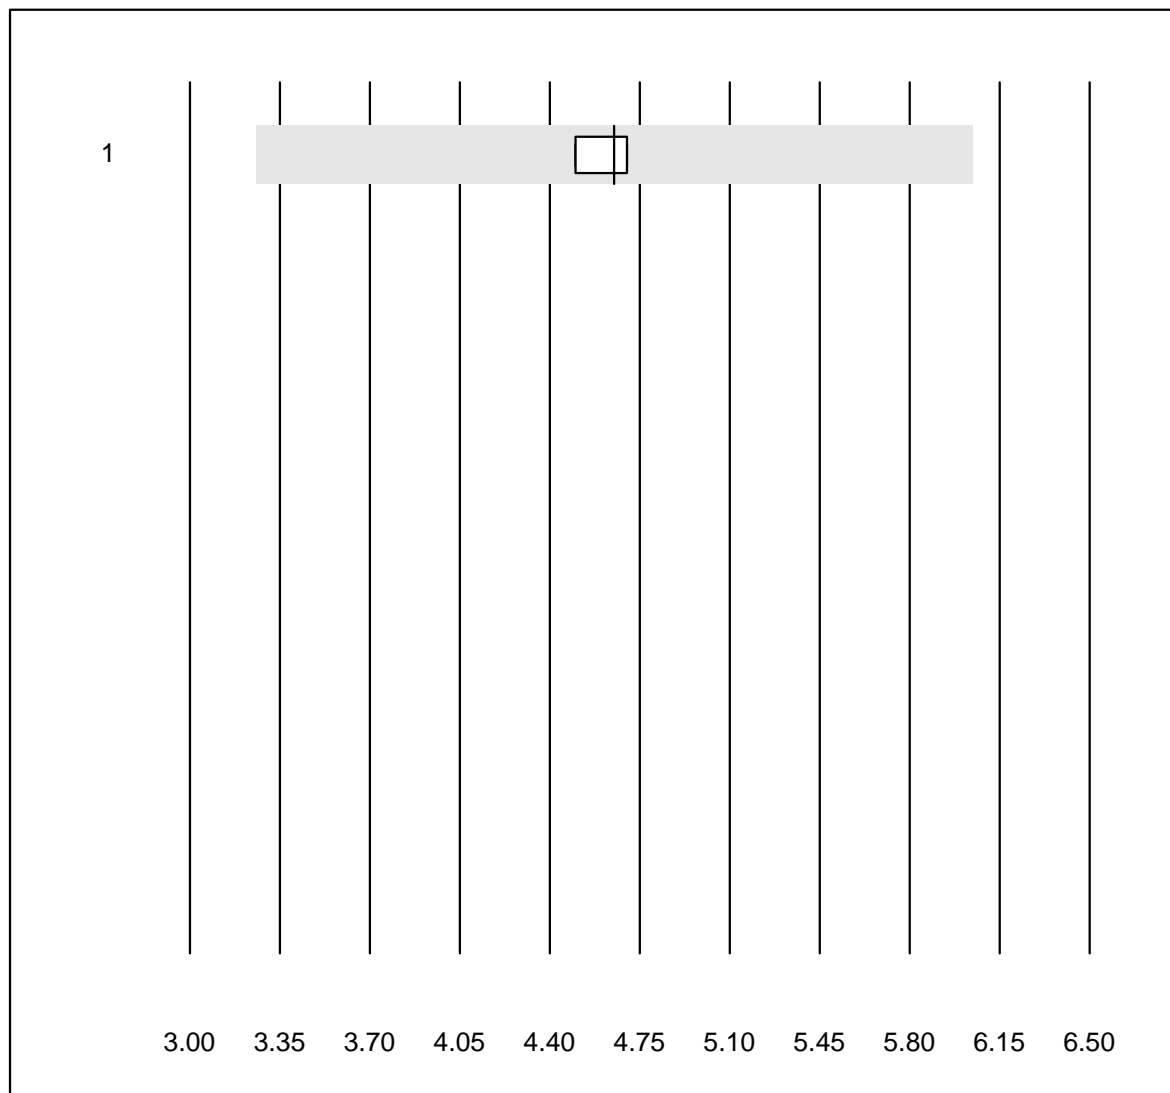


Tolérance MQ : 30 %

Beta-1-Globulin (%)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 électrophorèse	4	100.0	0.0	0.0	4.7	2.1	e



## Beta-2-Globulin

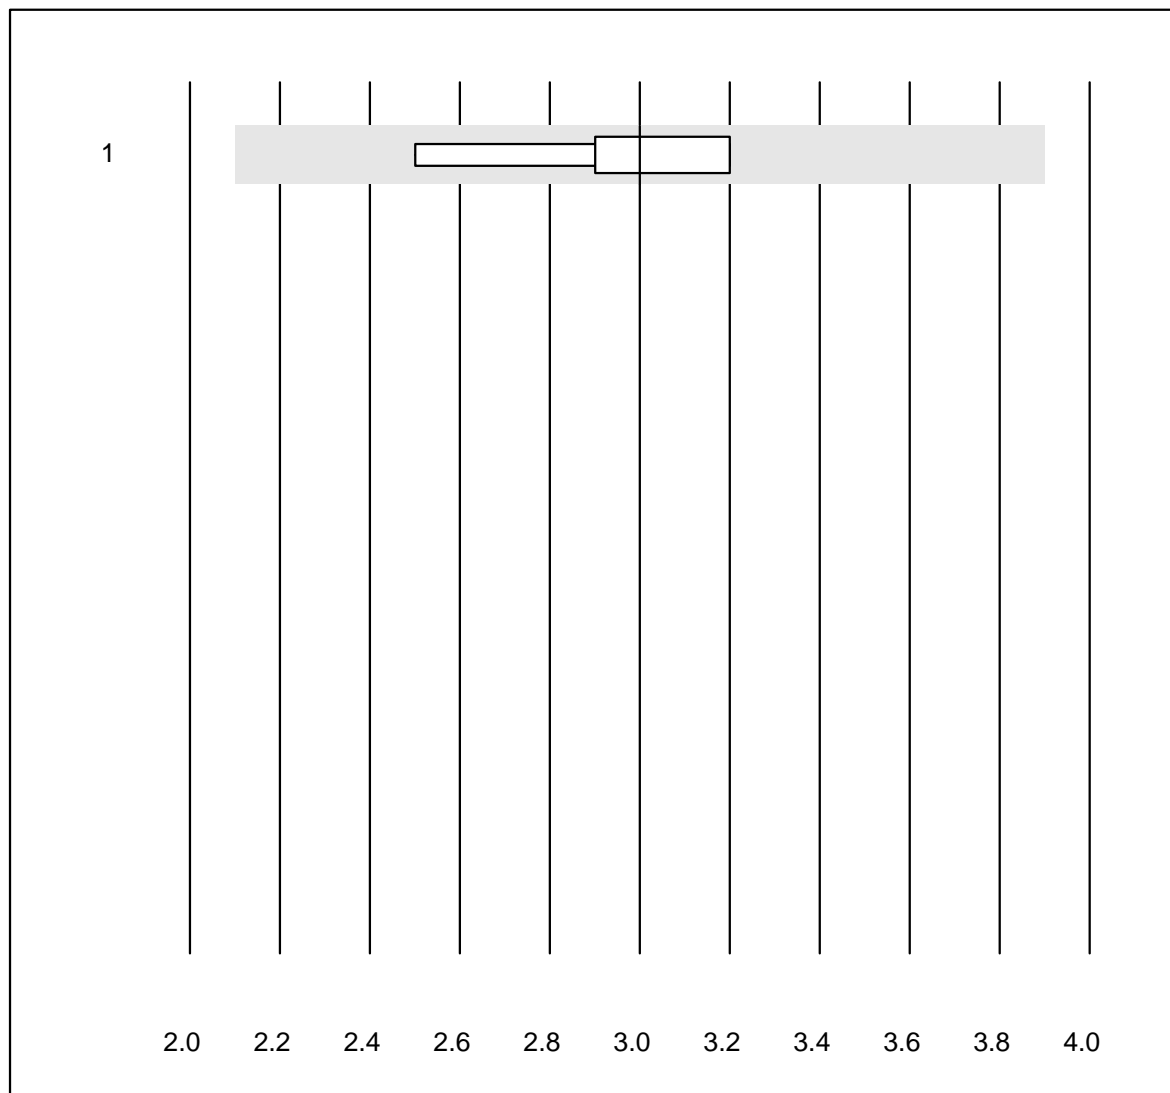


Tolérance MQ : 30 %

Beta-2-Globulin (%)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 électrophorèse	5	100.0	0.0	0.0	3.0	9.7	e*

## gamma-Globuline

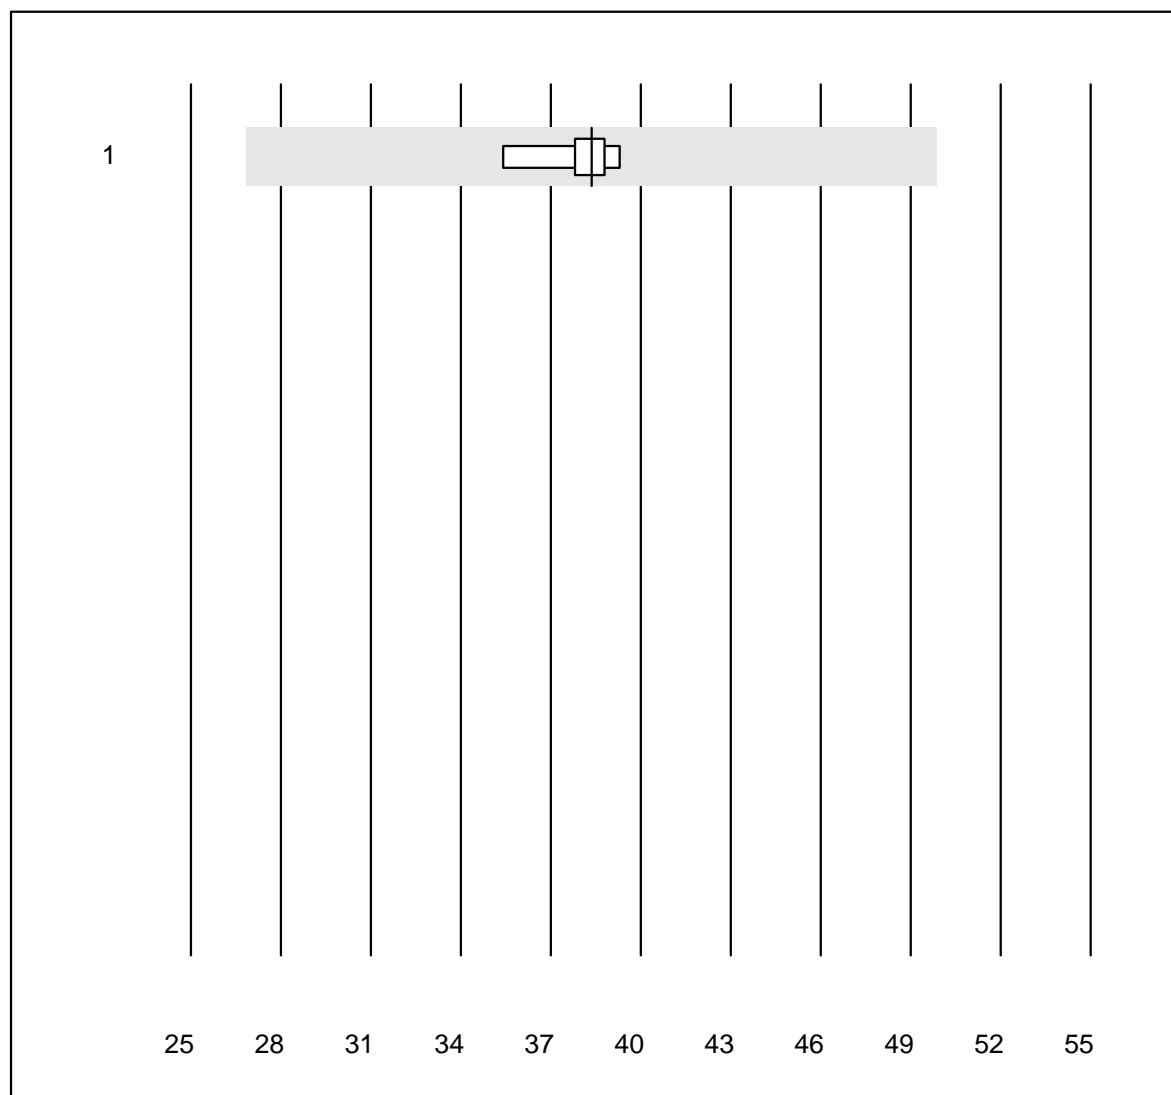


Tolérance MQ : 30 %

gamma-Globuline (%)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 électrophorèse	6	100.0	0.0	0.0	38.4	3.6	e

## Immundefixation

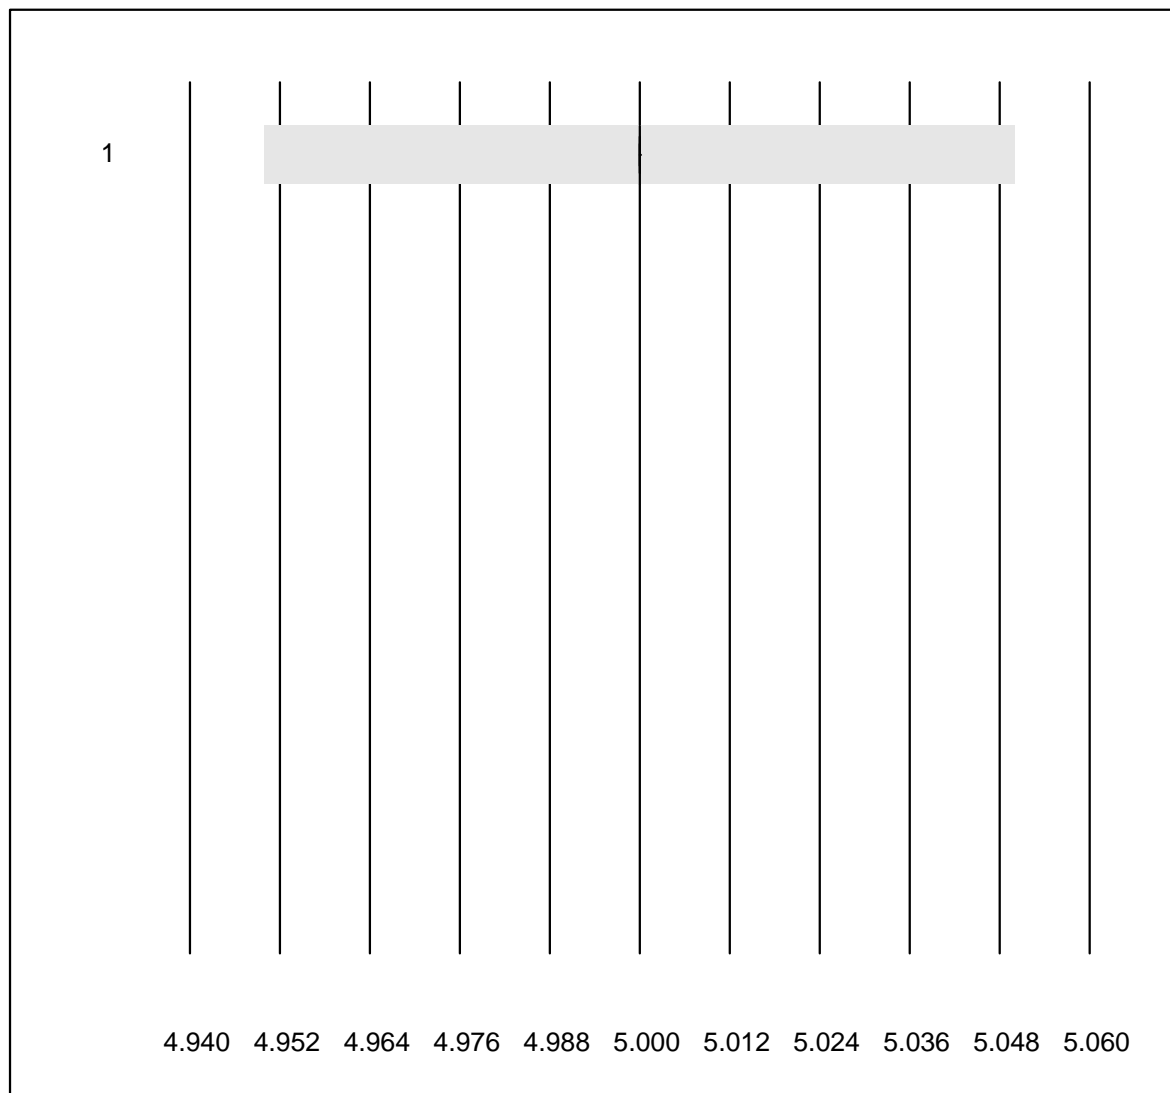


Tolérance MQ : 1 %

Immundefixation (Code)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 interprétation	8	100.0	0.0	0.0	5	0.0	e

## Folates érythrocytaires

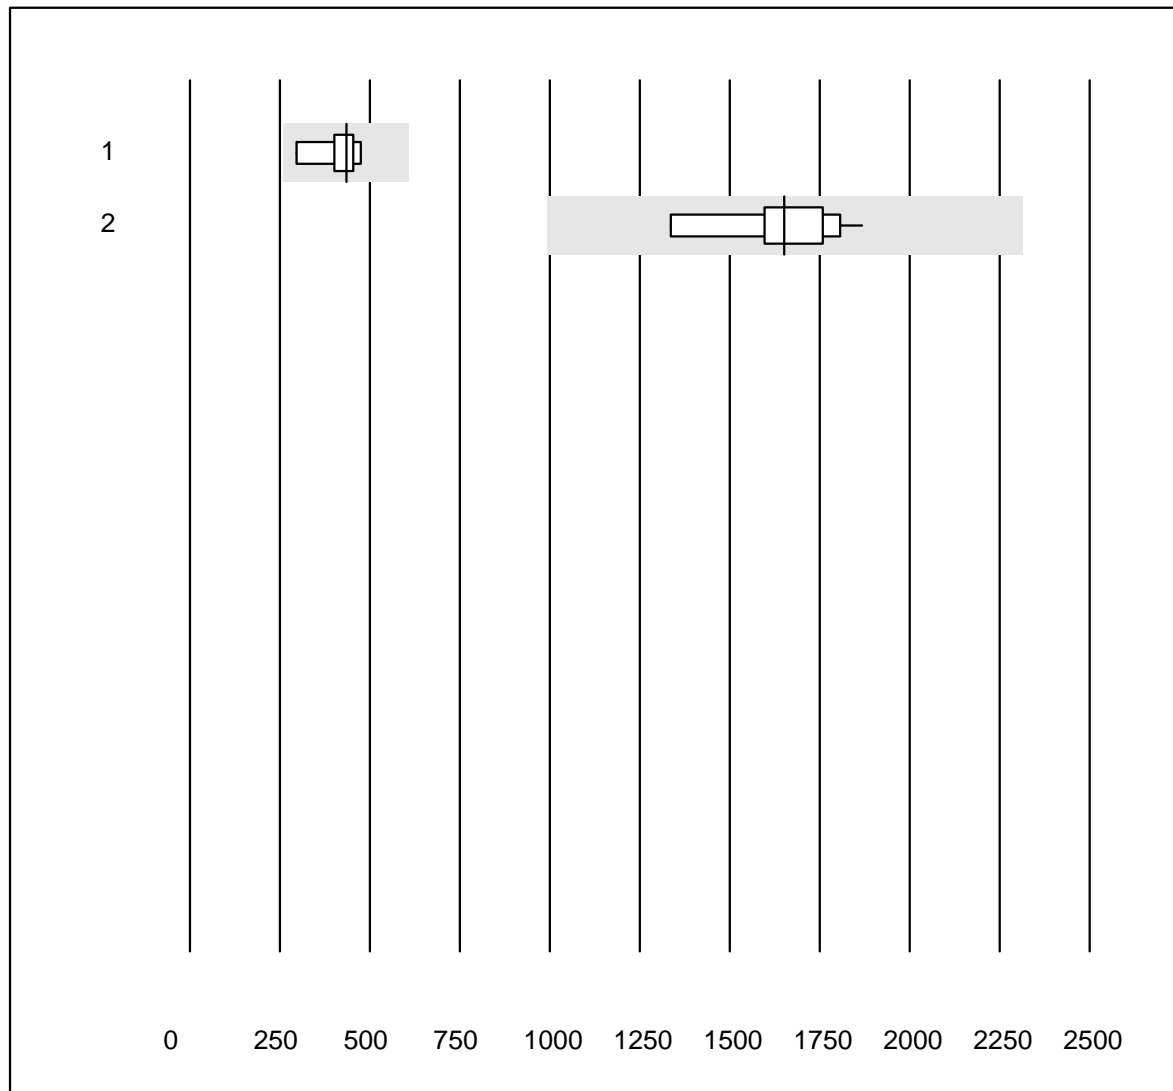


Tolérance MQ : 40 %

Folates érythrocytaires (nmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Architect	8	100.0	0.0	0.0	435	13.5	e
2	Cobas	10	100.0	0.0	0.0	1652	9.7	e

# Gallensäure

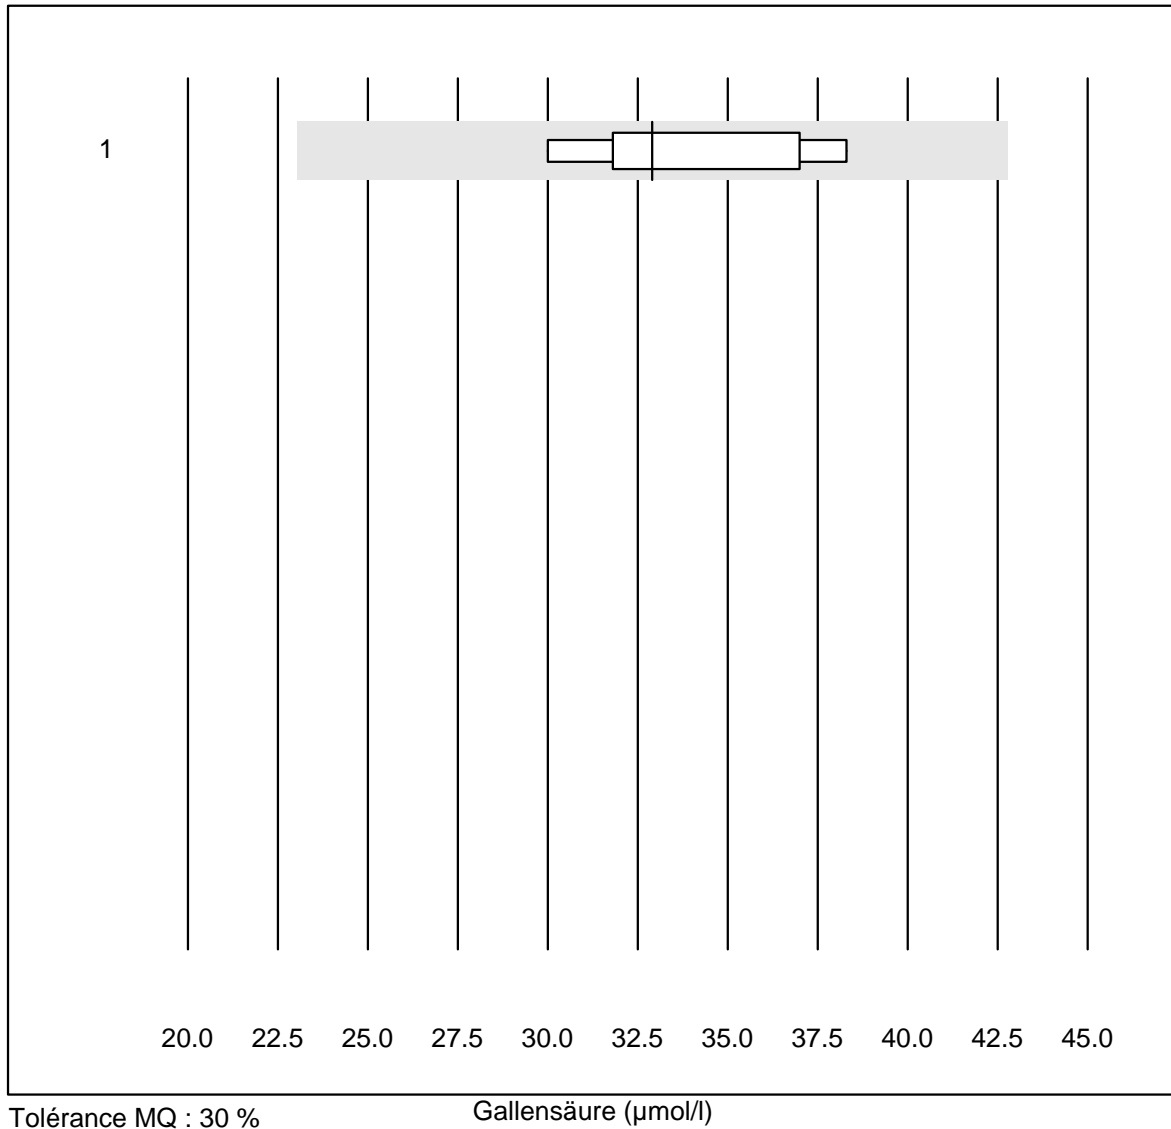

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	9	100.0	0.0	0.0	32.9	9.3	e

# BNP

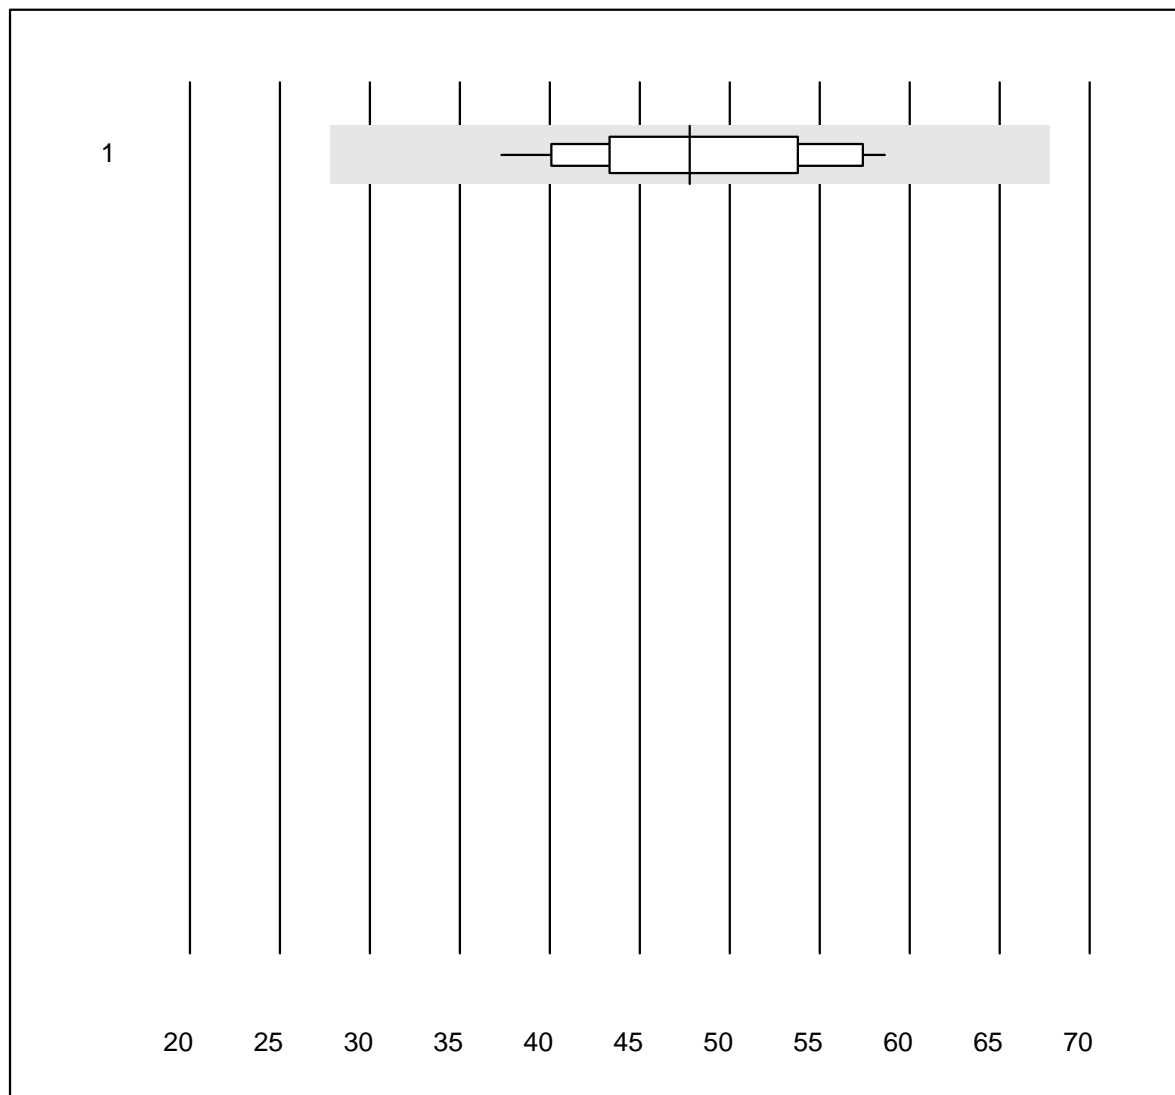


QUALAB Toleranz : 27 %  
 (< 75.0: +/- 20.0 ng/l)

BNP (ng/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Triage	15	100.0	0.0	0.0	47.8	13.9	e*

## Troponin Triage

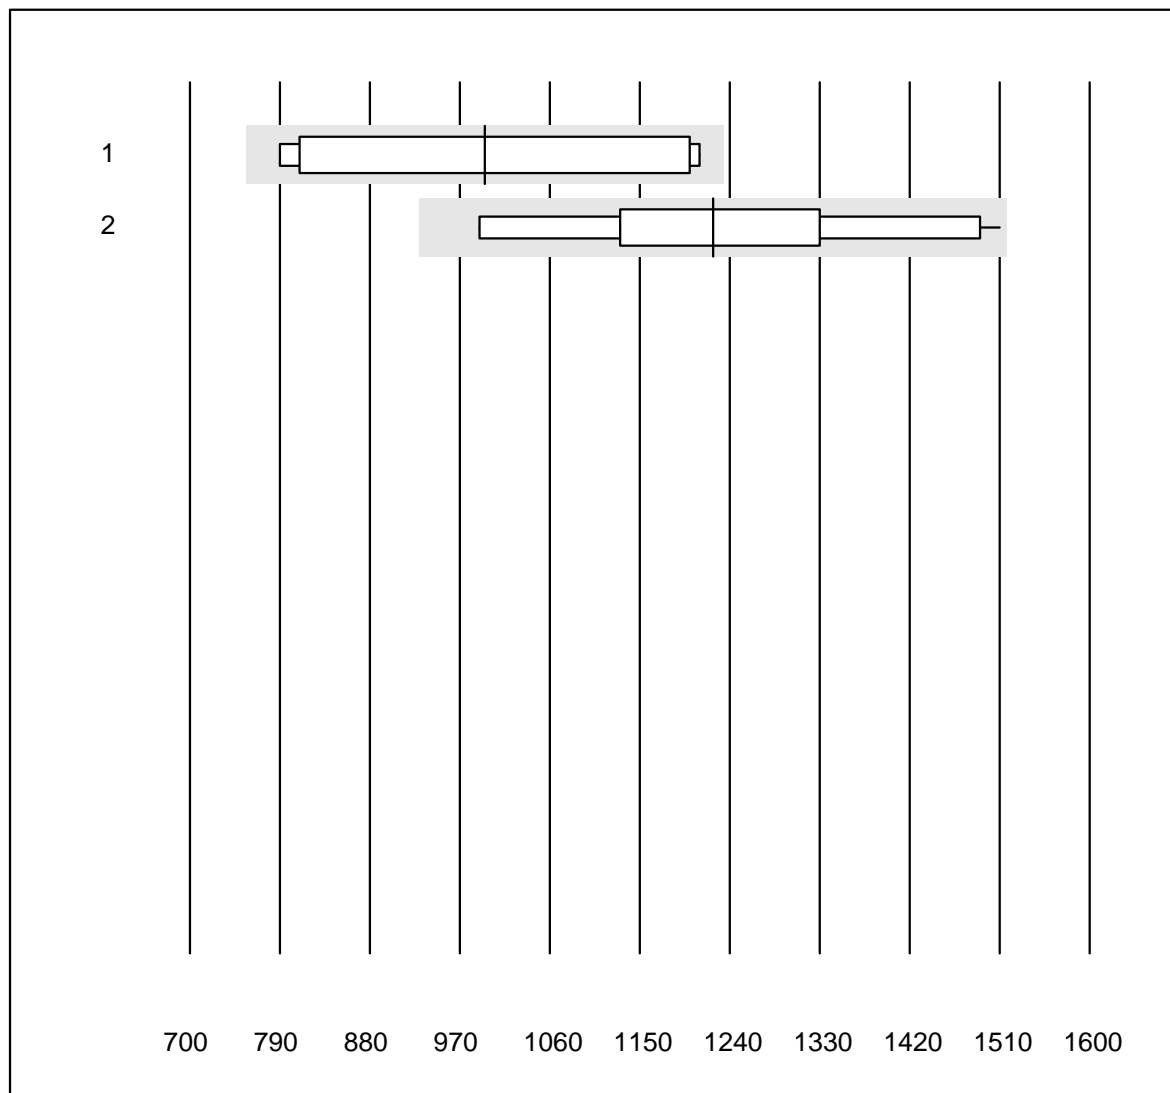


QUALAB Toleranz : 24 %

Troponin Triage (ng/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Triage SOB/Cardiac	8	87.5	0.0	12.5	995.00	17.0	e*
2	Triage Next Gen	17	58.8	0.0	41.2	1223.00	14.7	e*

## NT-pro BNP

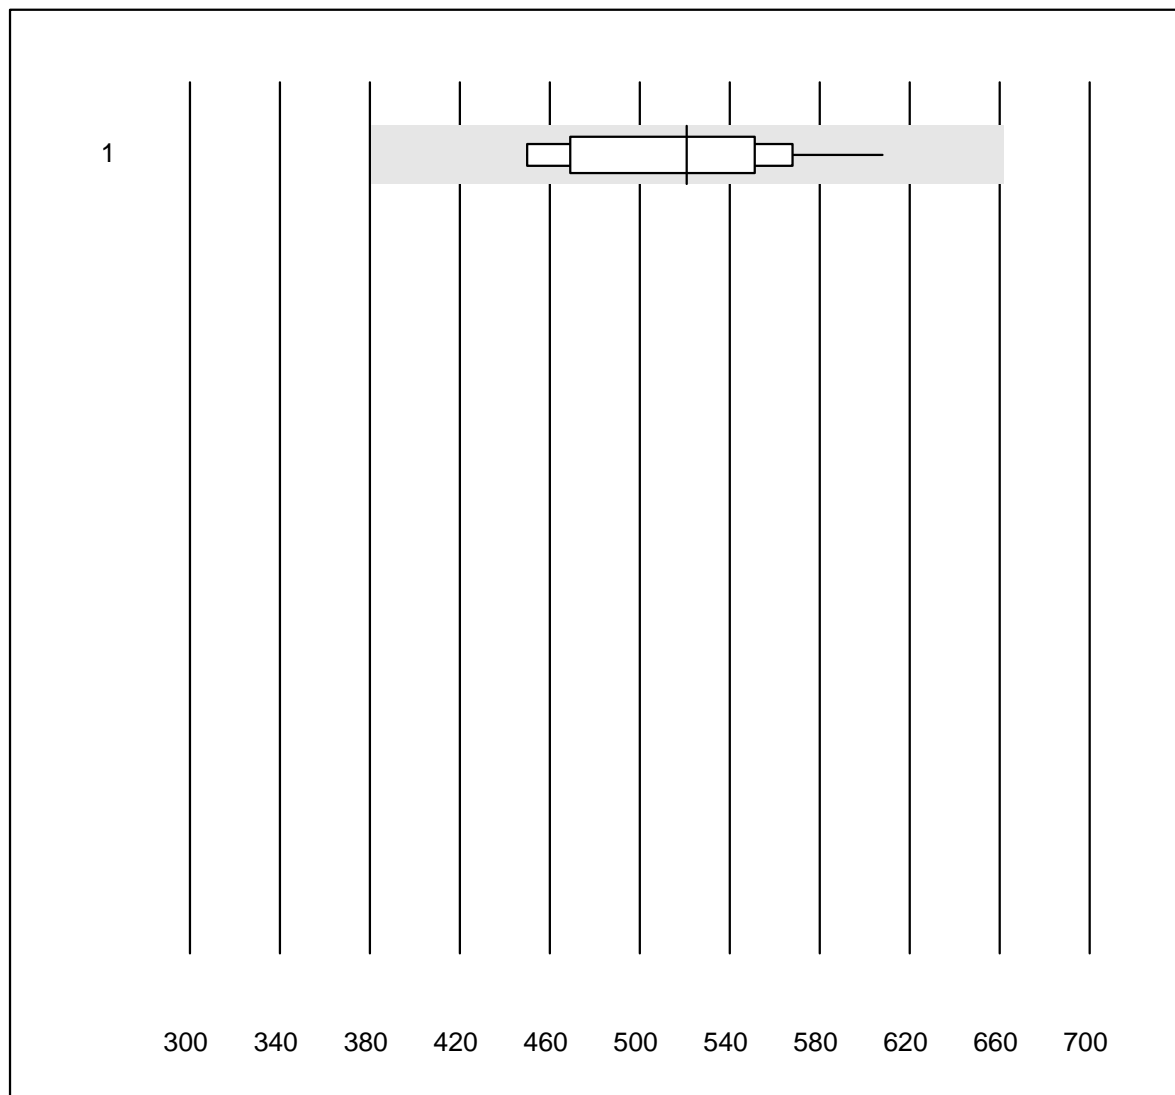


QUALAB Toleranz : 27 %

NT-pro BNP (ng/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Triage	11	100.0	0.0	0.0	521	9.6	e



## D-Dimere Triage

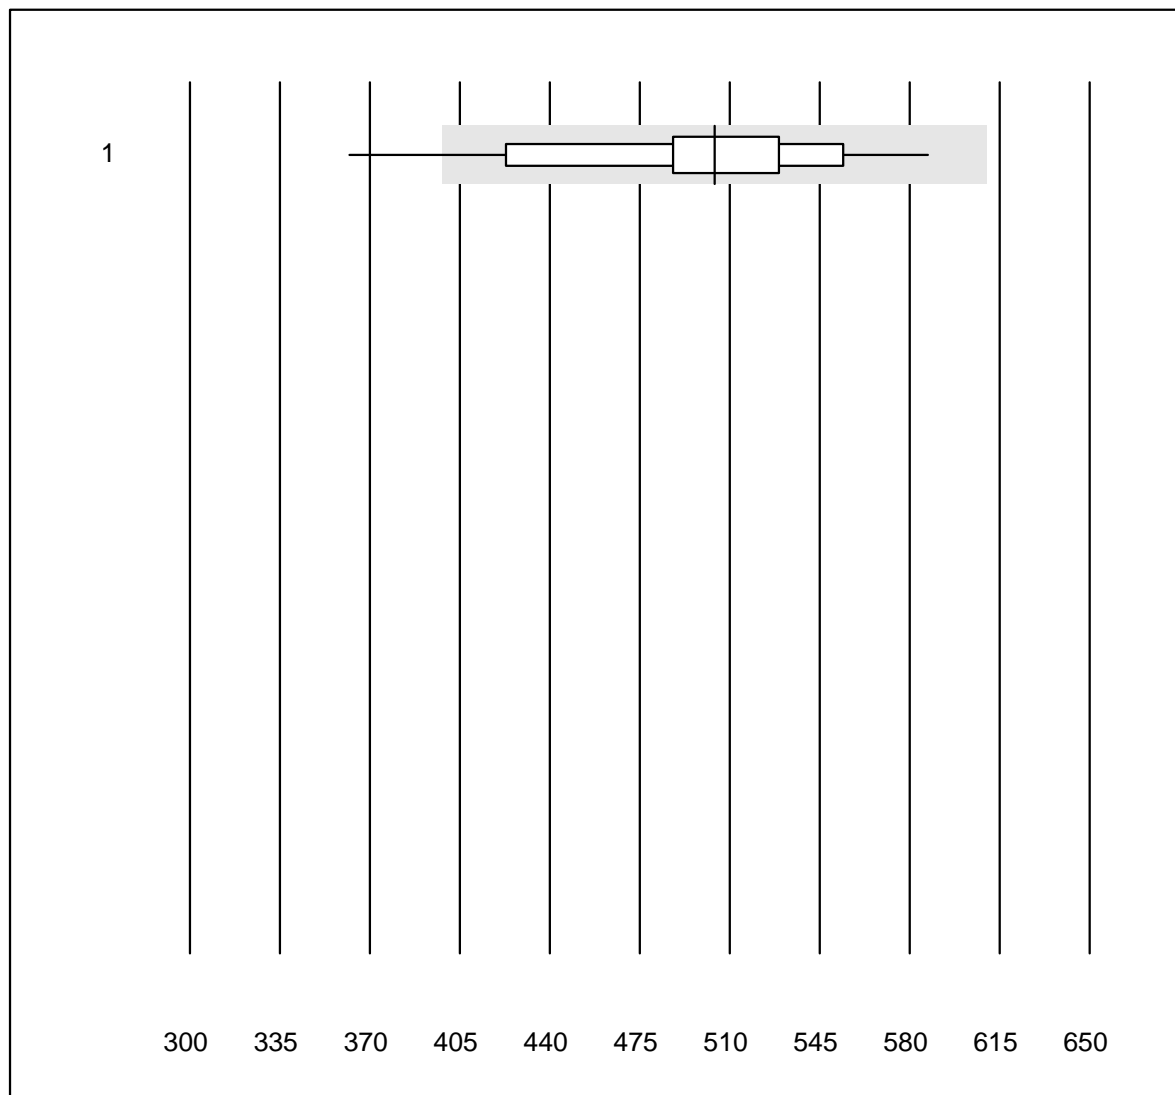


QUALAB Toleranz : 21 %

D-Dimere Triage (ng/ml)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Triage	33	97.0	3.0	0.0	504.09	10.1	e

### CK-MB Triage

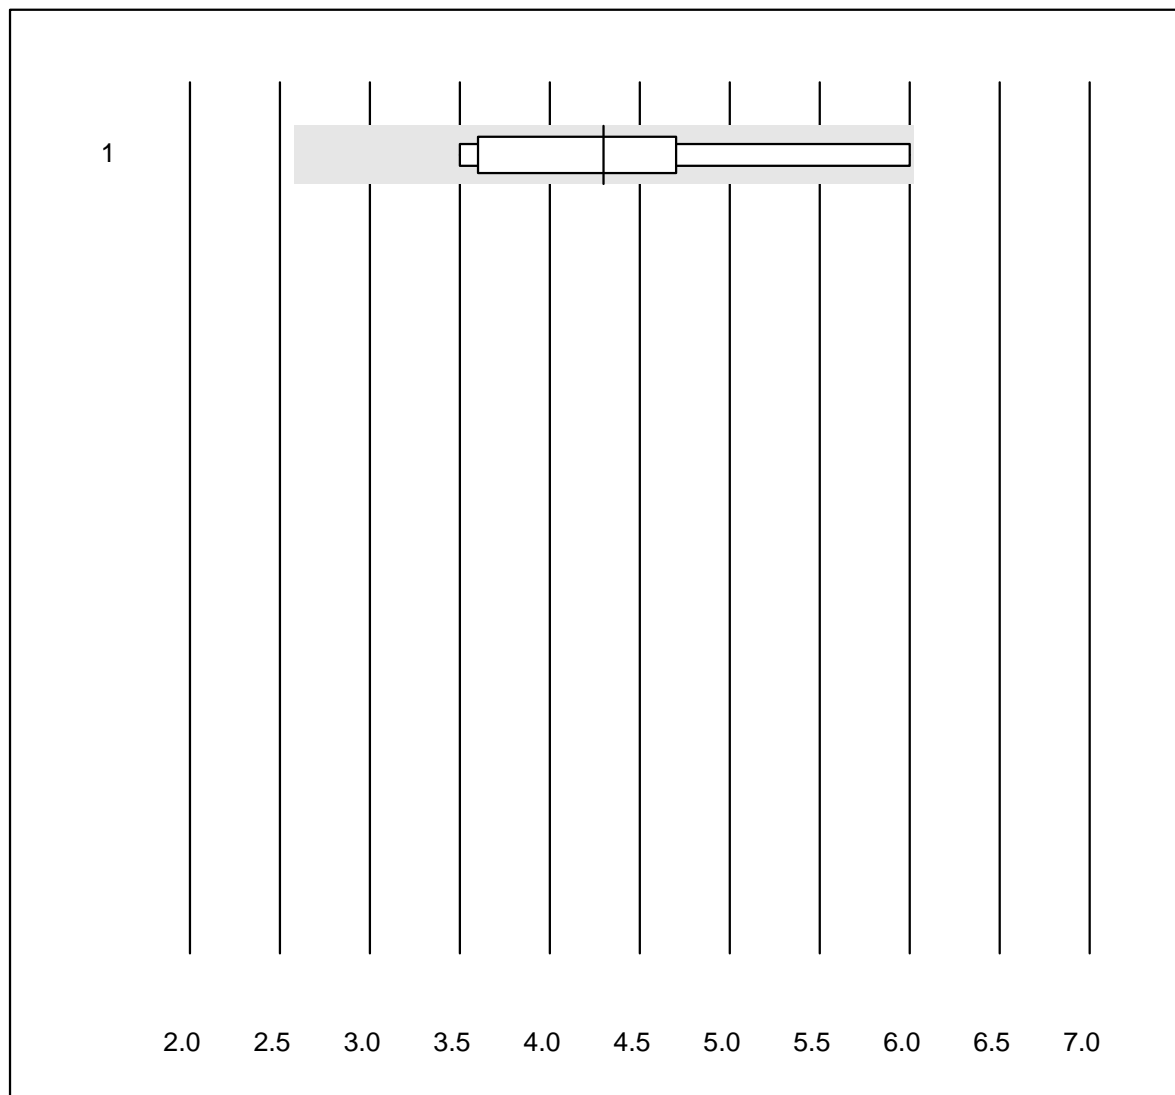


Tolérance MQ : 40 %

CK-MB Triage (µg/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Triage	8	100.0	0.0	0.0	4.3	19.2	e*

## Myoglobin Triage

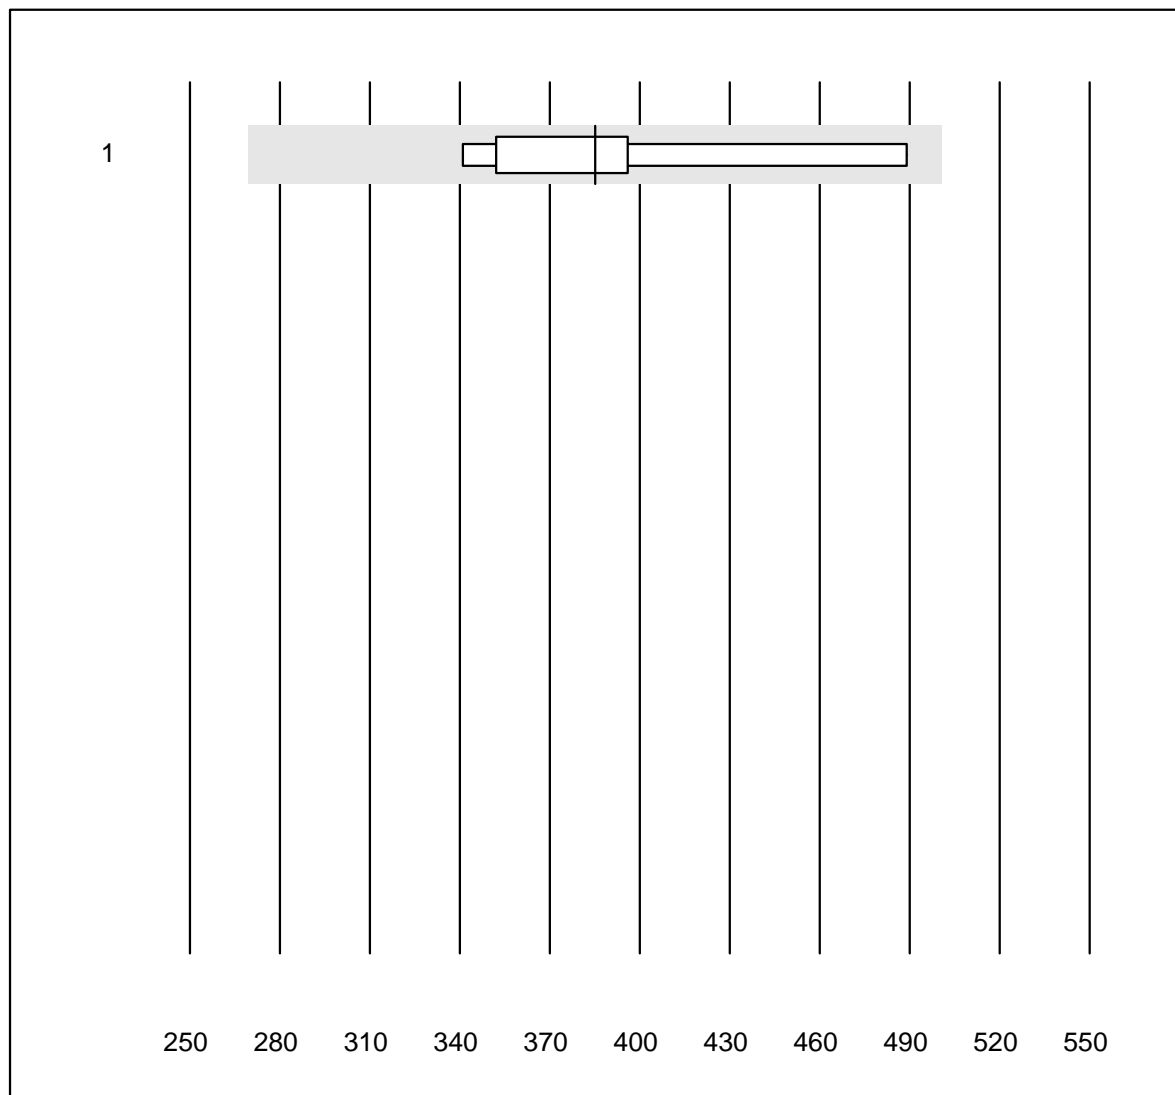


QUALAB Toleranz : 30 %

Myoglobin Triage (µg/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Triage	8	100.0	0.0	0.0	385.0	14.0	e*

## Vitamine D 25 (OH)

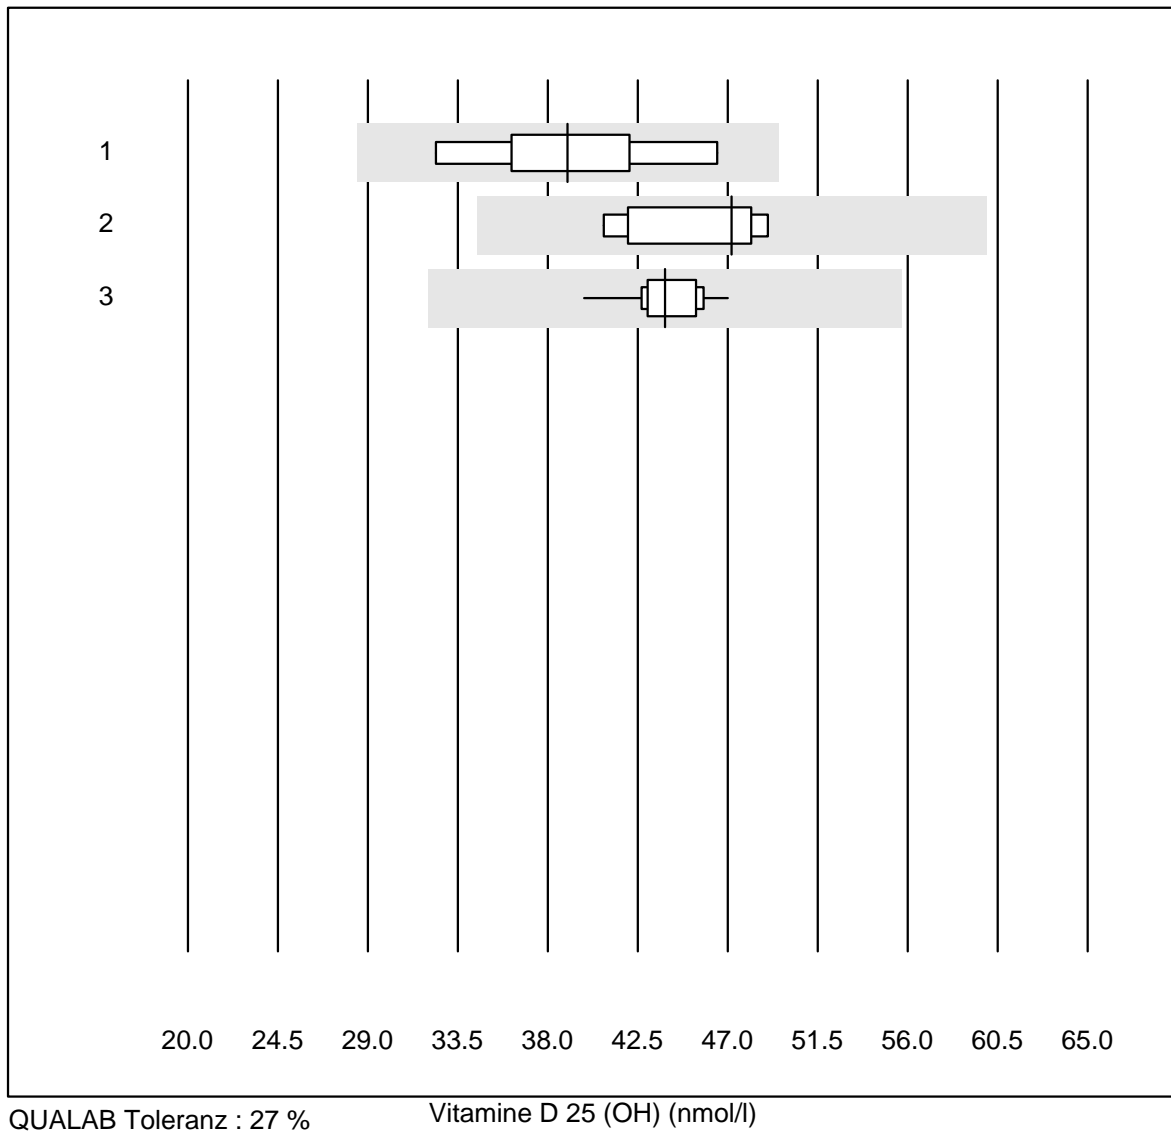


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	8	100.0	0.0	0.0	39.0	11.6	e*
2 VIDAS	7	100.0	0.0	0.0	47.2	7.1	e
3 Architect	11	100.0	0.0	0.0	43.8	4.4	e

## AMH

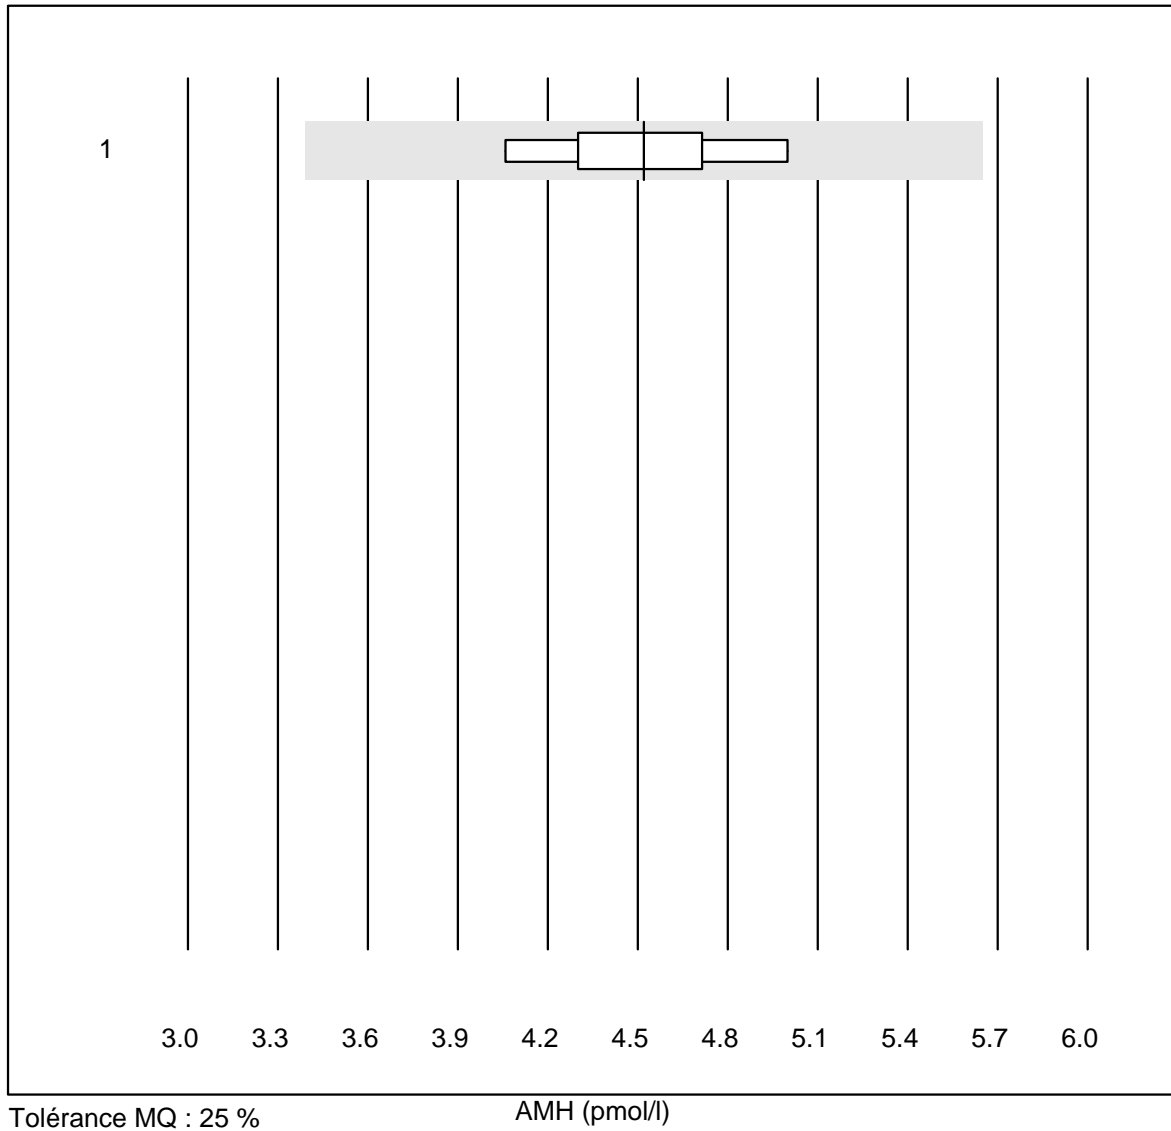


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	9	100.0	0.0	0.0	4.5	6.4	e

# Calcitonin

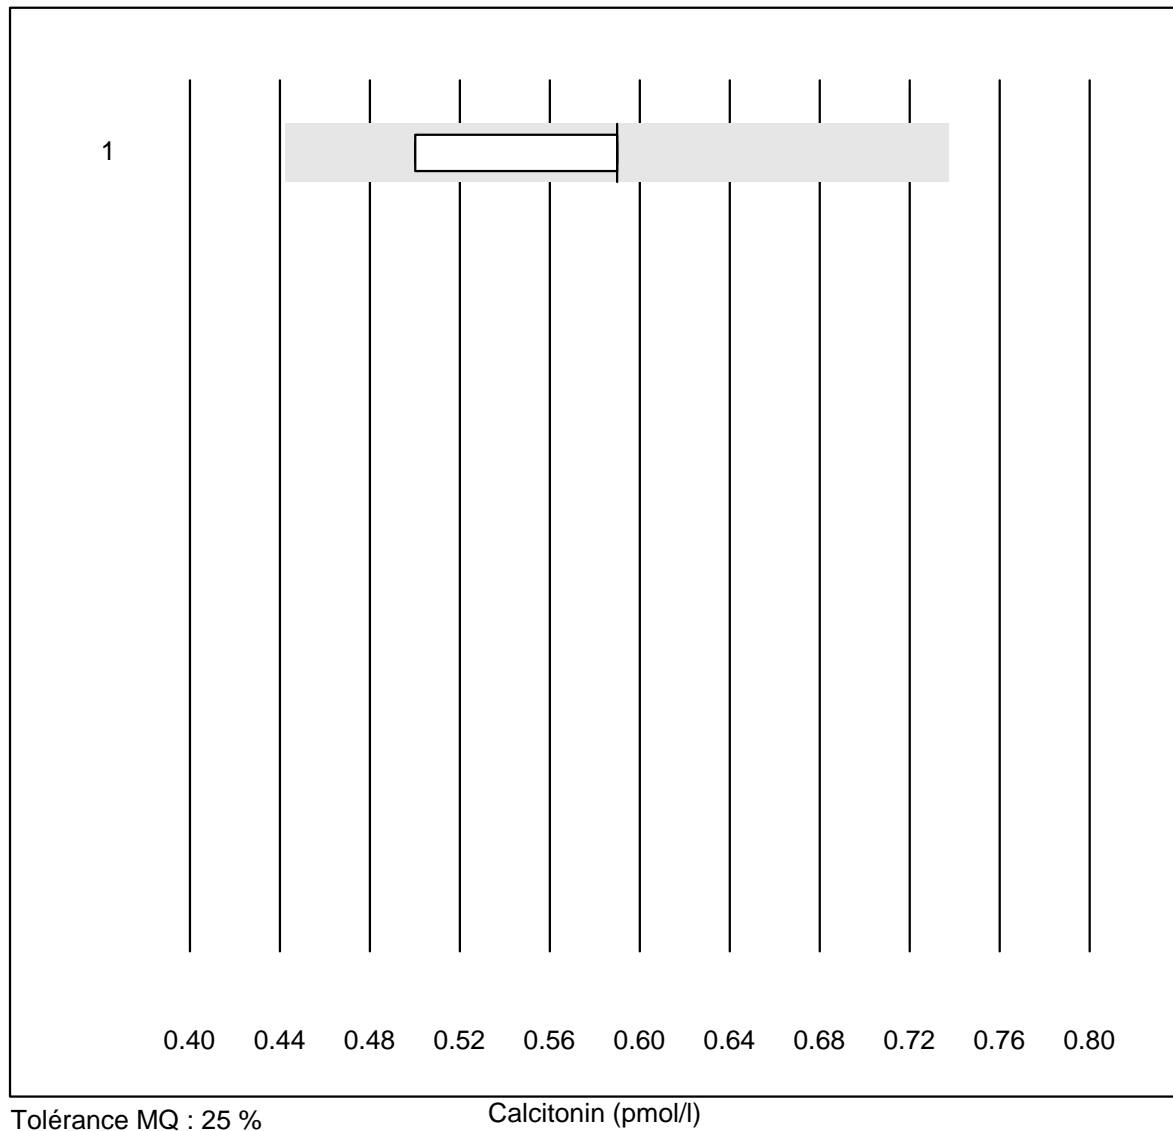

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	0.6	7.9	e*

# IGF-BP3

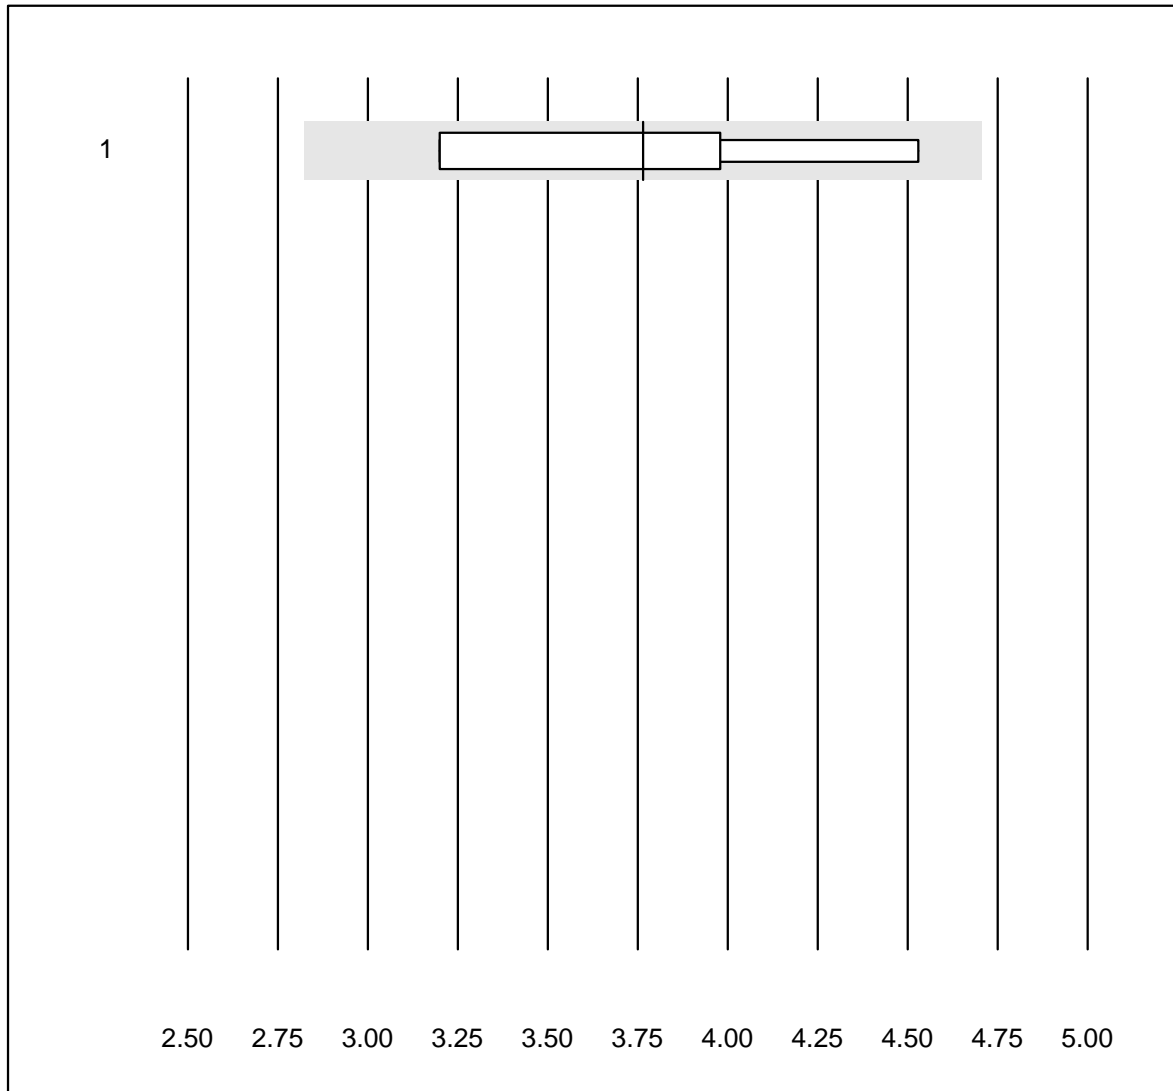


Tolérance MQ : 25 %

IGF-BP3 (mg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	3.77	15.0	e*

## Anti Thyreoglobulin

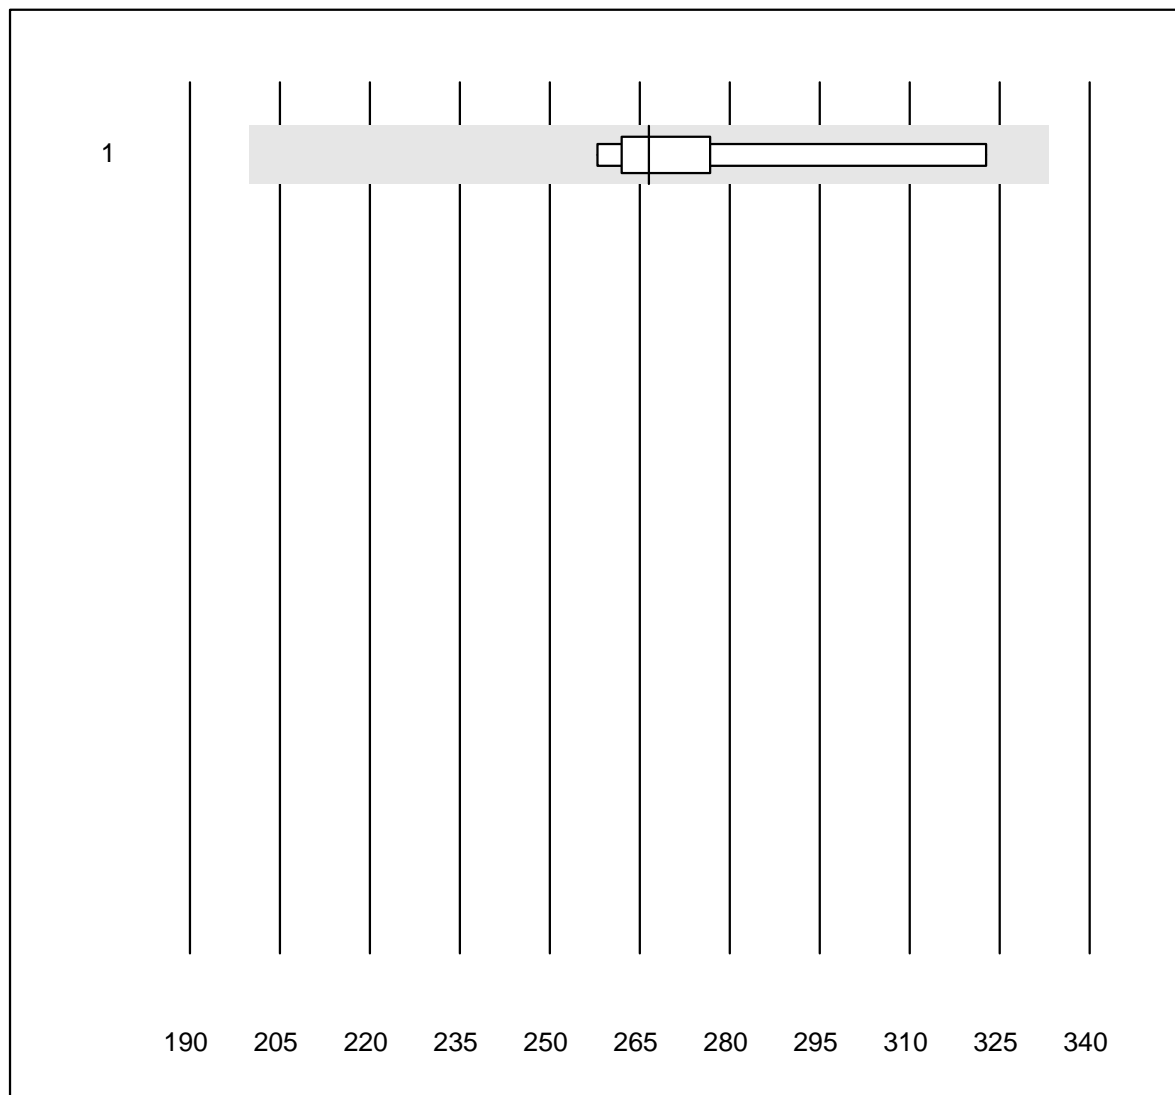


Tolérance MQ : 25 %

Anti Thyreoglobulin (IU/ml)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	8	100.0	0.0	0.0	267	7.5	e



## Anti TPO

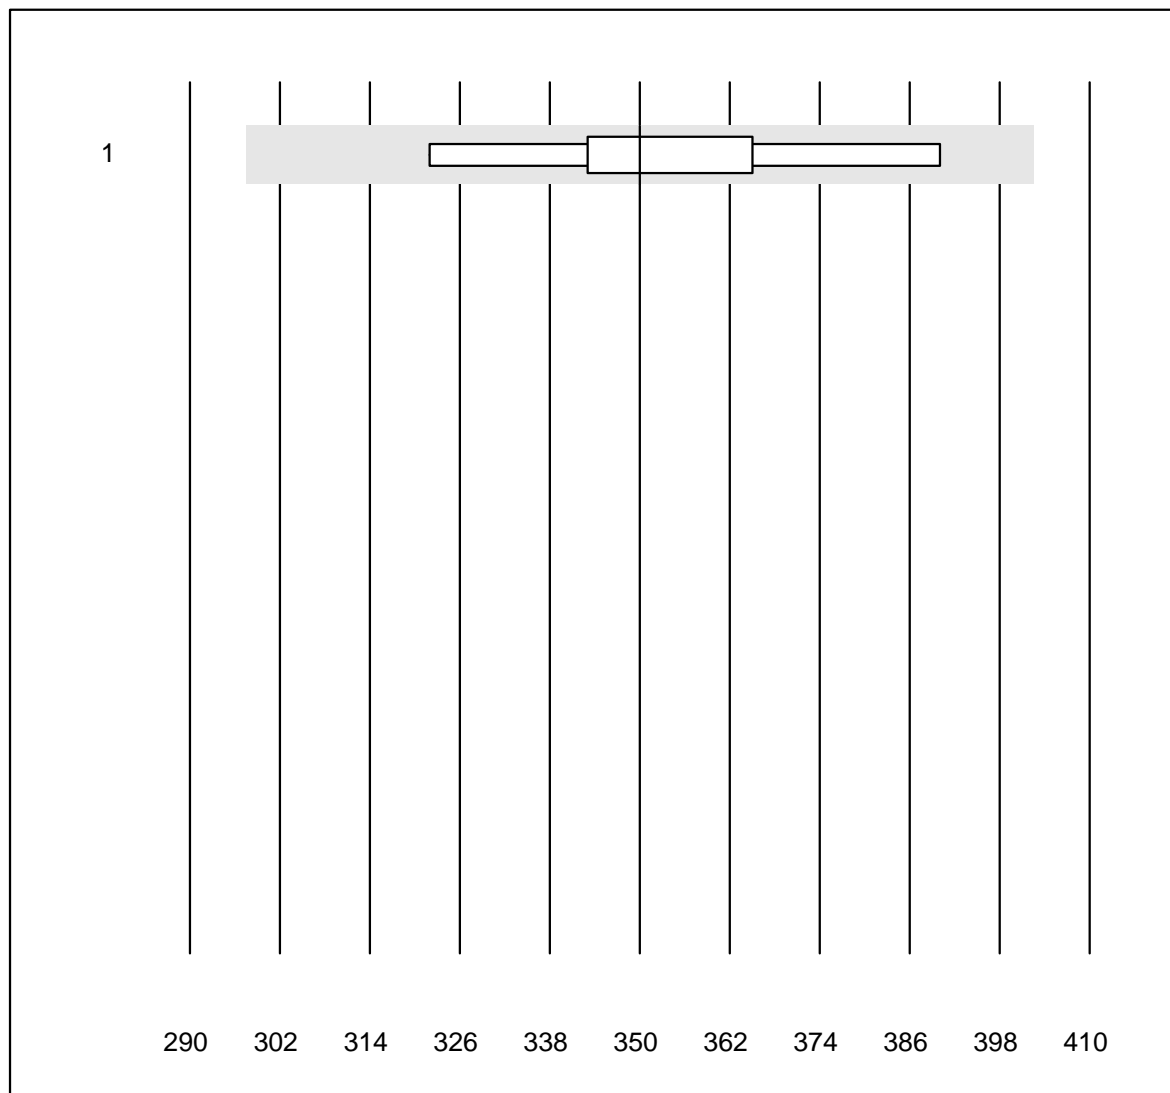


QUALAB Toleranz : 15 %

Anti TPO (IU/ml)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	7	100.0	0.0	0.0	350	5.9	e*

# TRAK

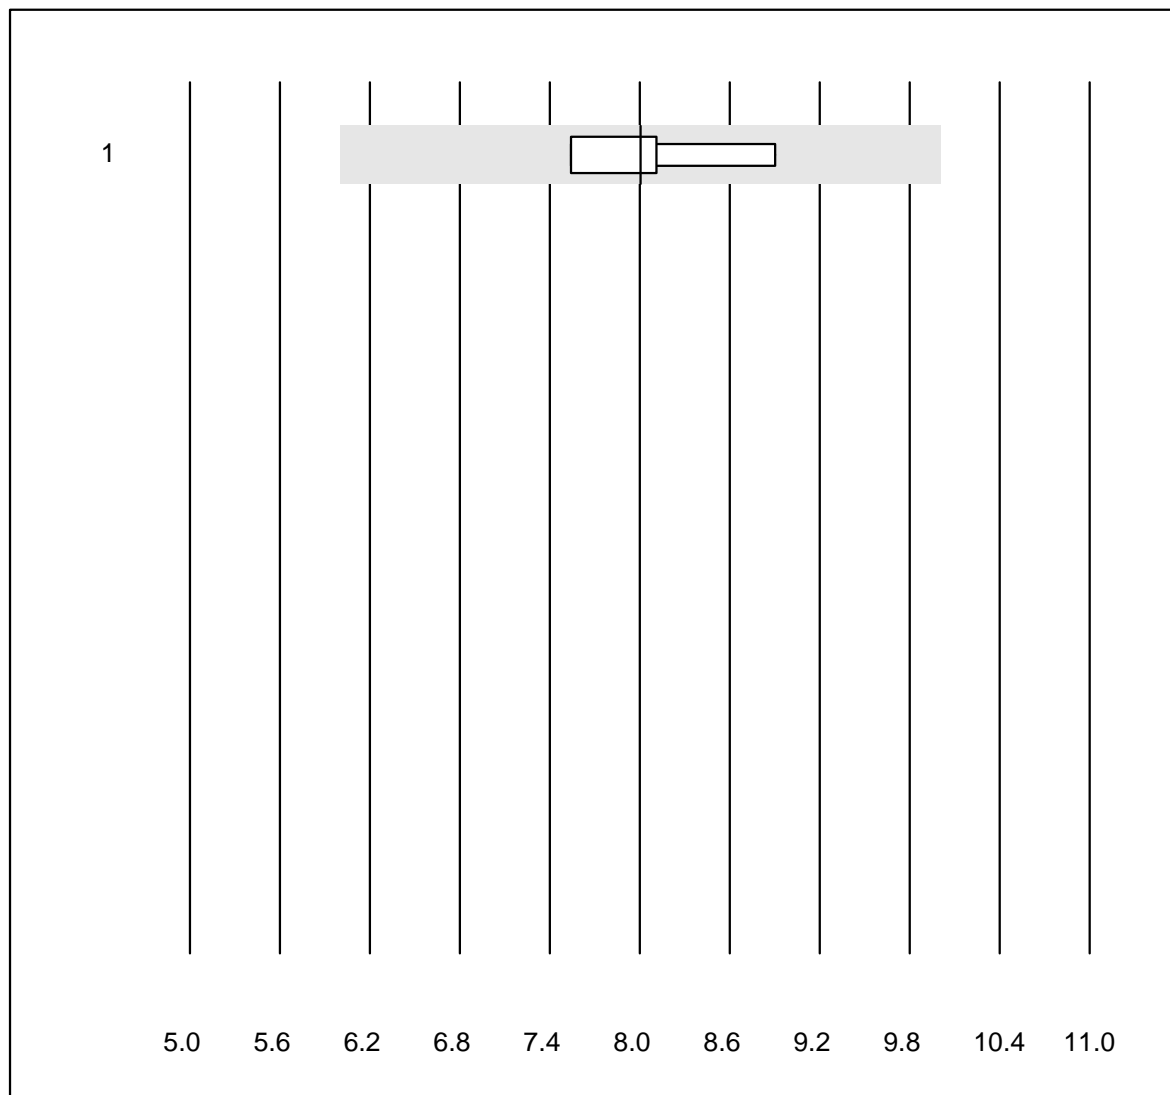


Tolérance MQ : 25 %

TRAK (IU/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Kryptor	4	100.0	0.0	0.0	8.01	7.1	e*

## Créatinine WB

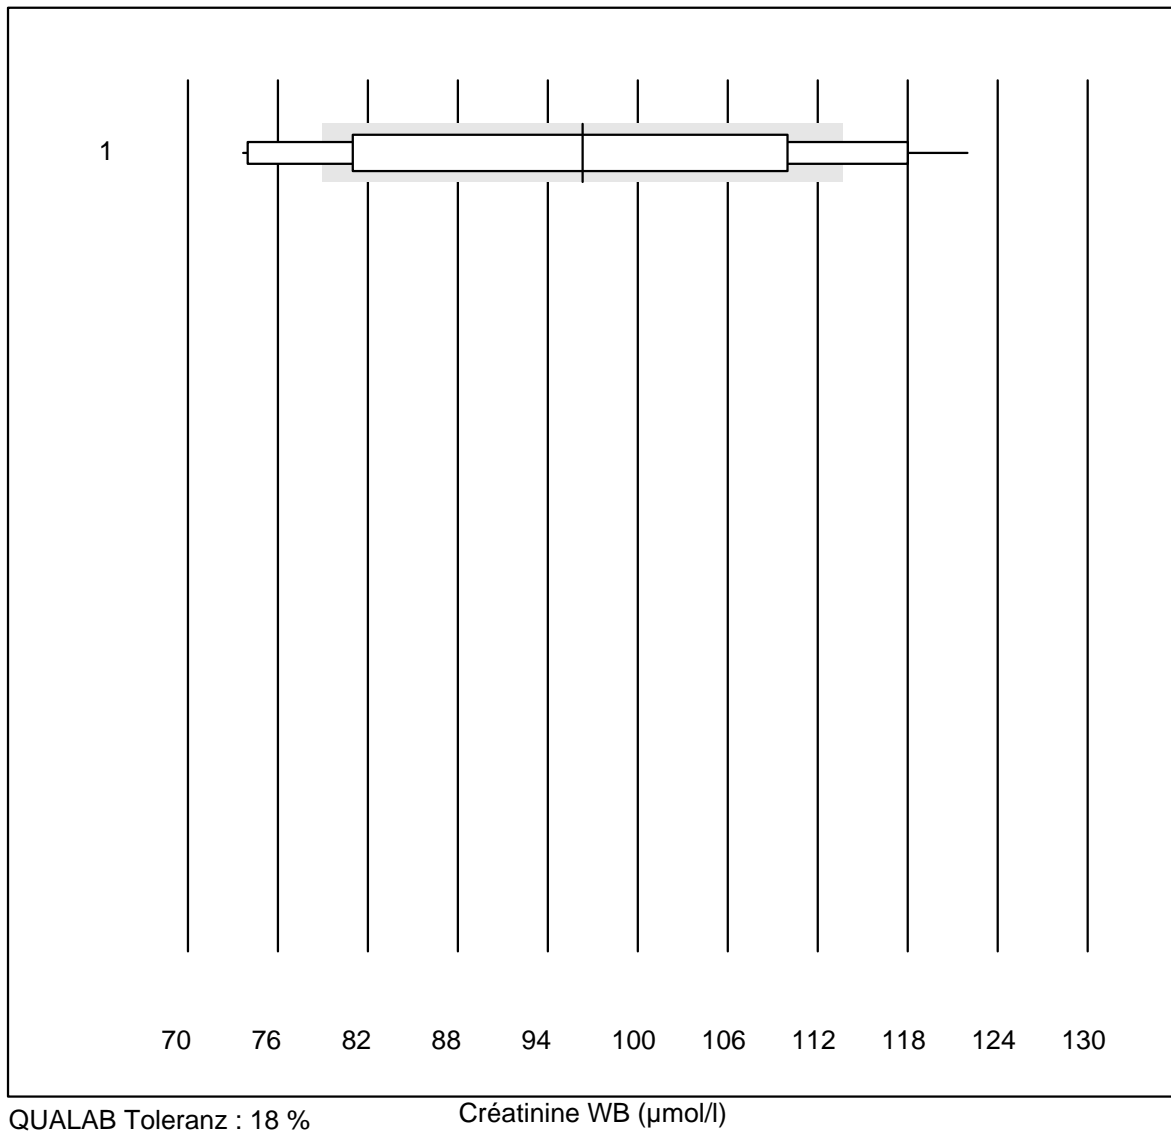

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Statsensor i / Nova	49	51.1	22.4	26.5	96	15.7	e*

## Calcium-urine

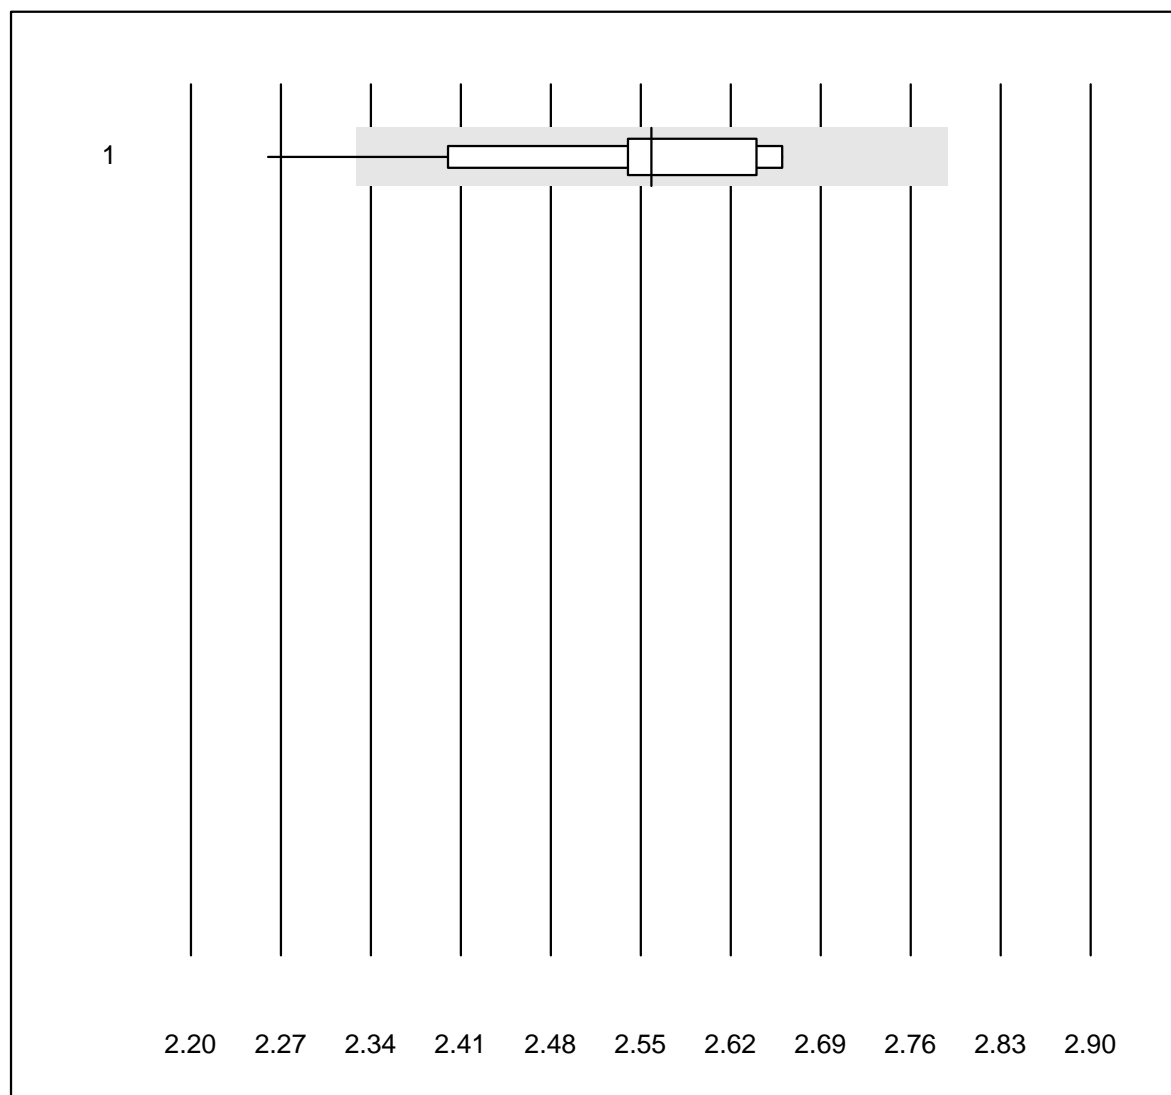


Tolérance MQ : 9 %

Calcium-urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	18	94.4	5.6	0.0	2.56	4.2	e

## Chlorures-urine

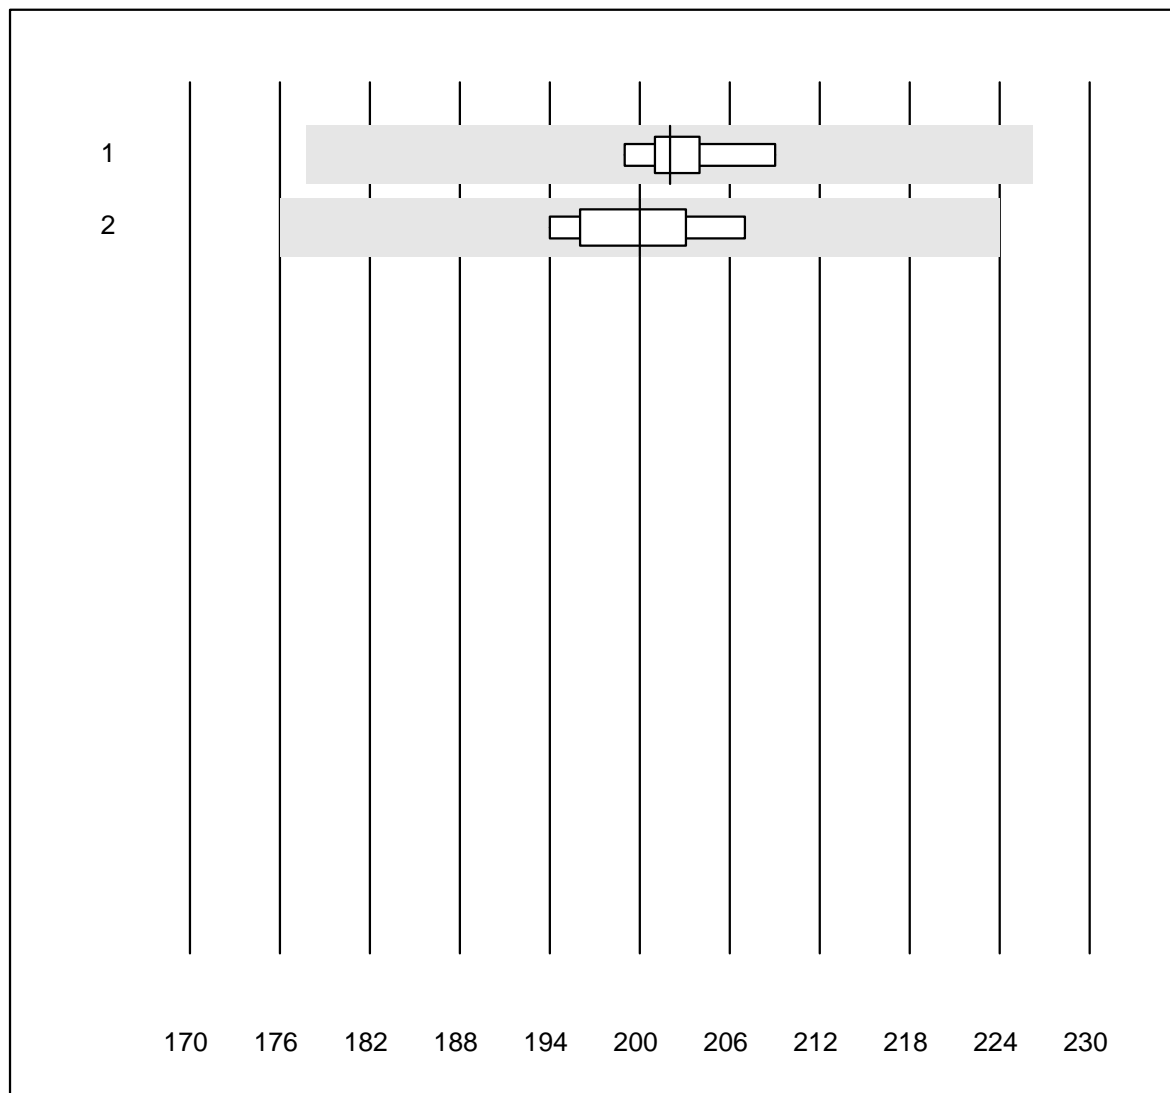


Tolérance MQ : 12 %

Chlorures-urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	5	100.0	0.0	0.0	202	1.9	e
2	Cobas	7	100.0	0.0	0.0	200	2.2	e

## Glucose-urine

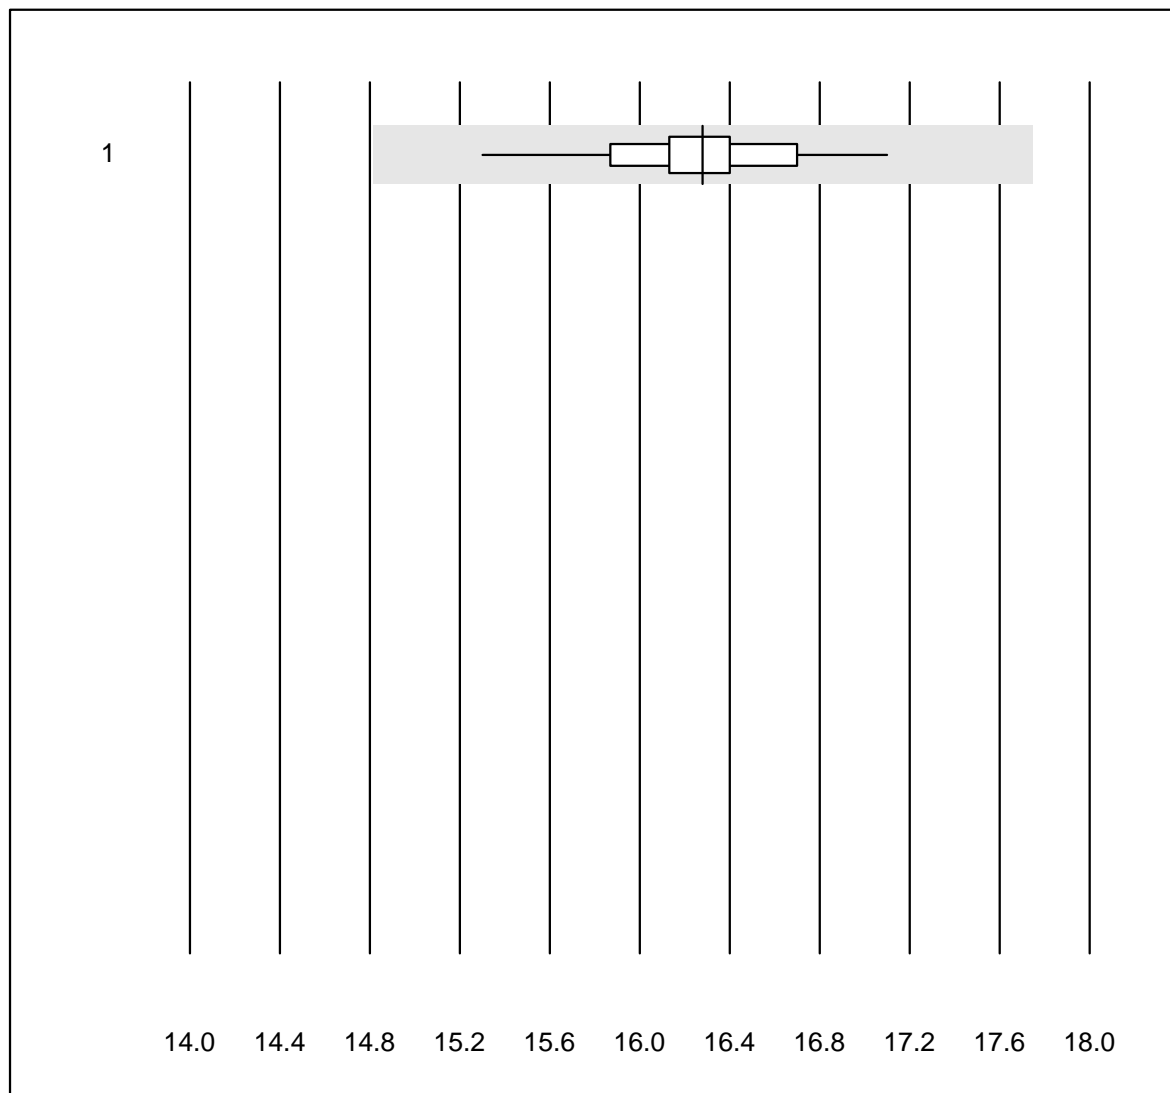


QUALAB Toleranz : 9 %

Glucose-urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	17	100.0	0.0	0.0	16.3	2.3	e

## Magnésium-urine

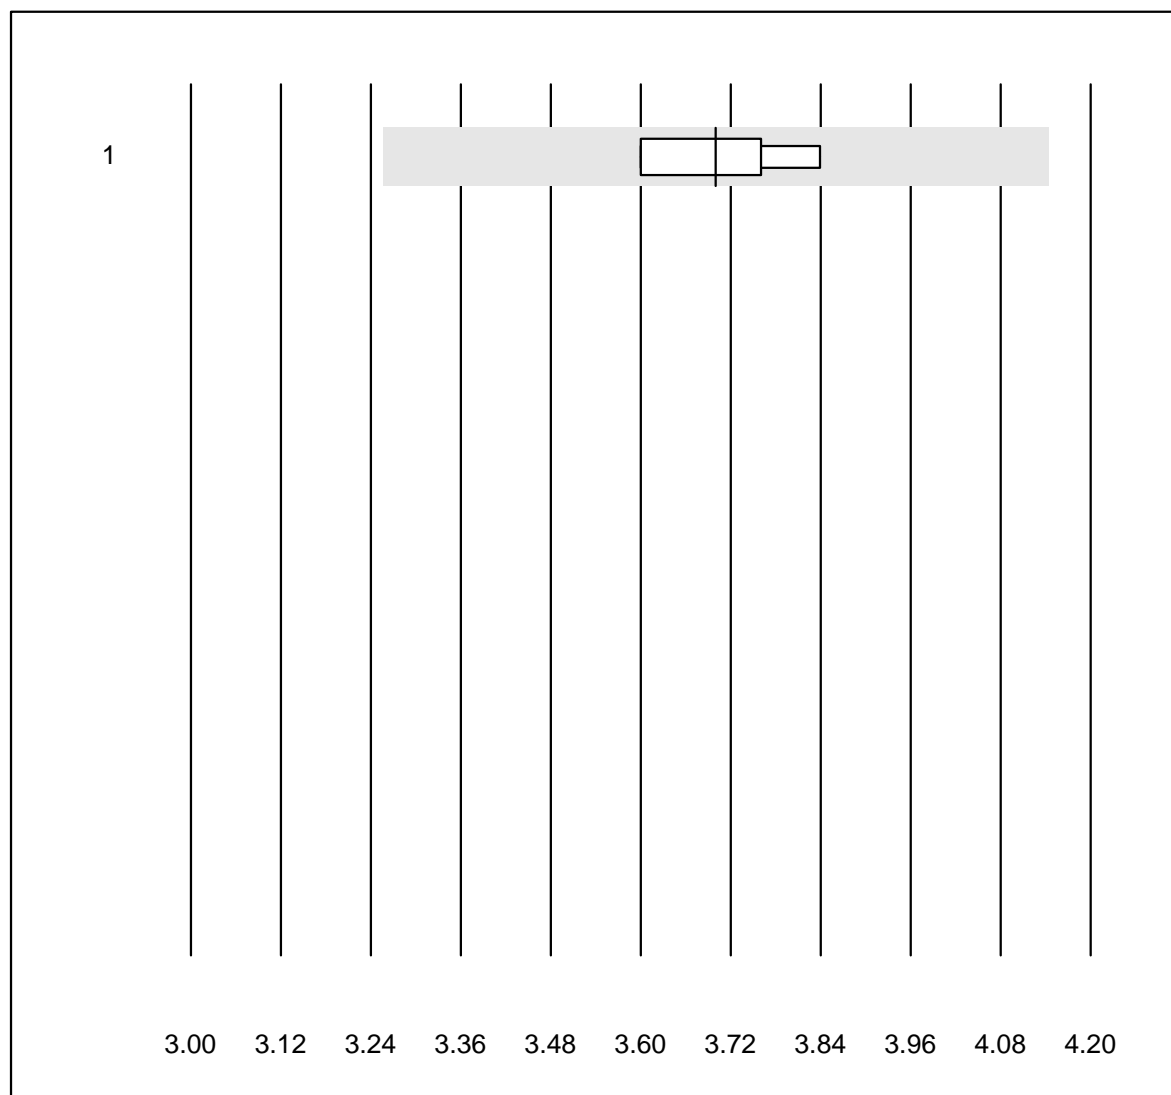


Tolérance MQ : 12 %

Magnésium-urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Efulft	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	8	100.0	0.0	0.0	3.70	2.4	e

## Osmolalité-urine

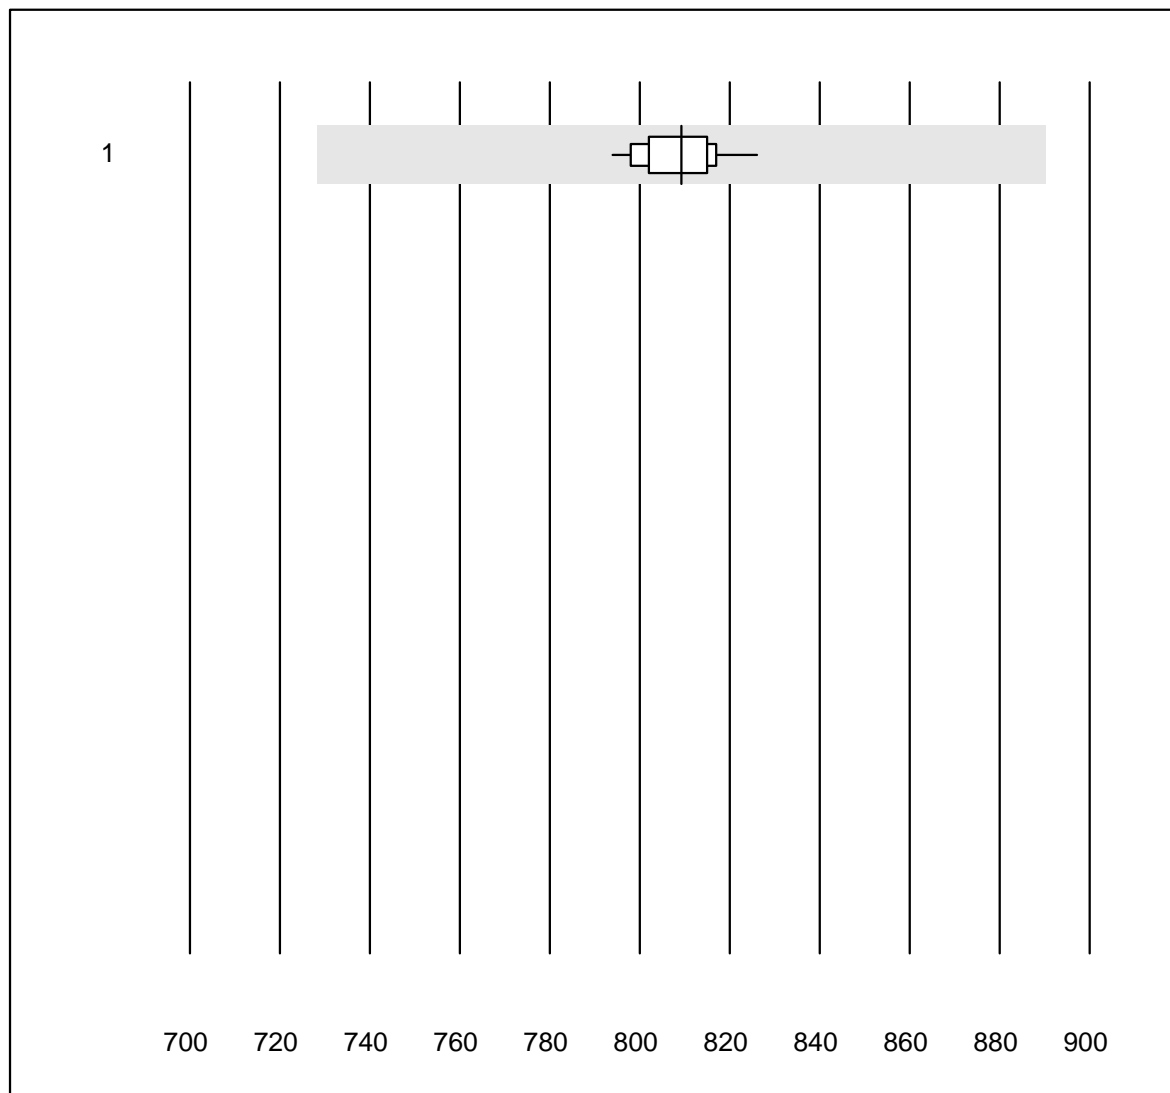


Tolérance MQ : 10 %

Osmolalité-urine (mosm/kg)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cryoscopie	14	100.0	0.0	0.0	809	1.1	e



## Phosphore-urine

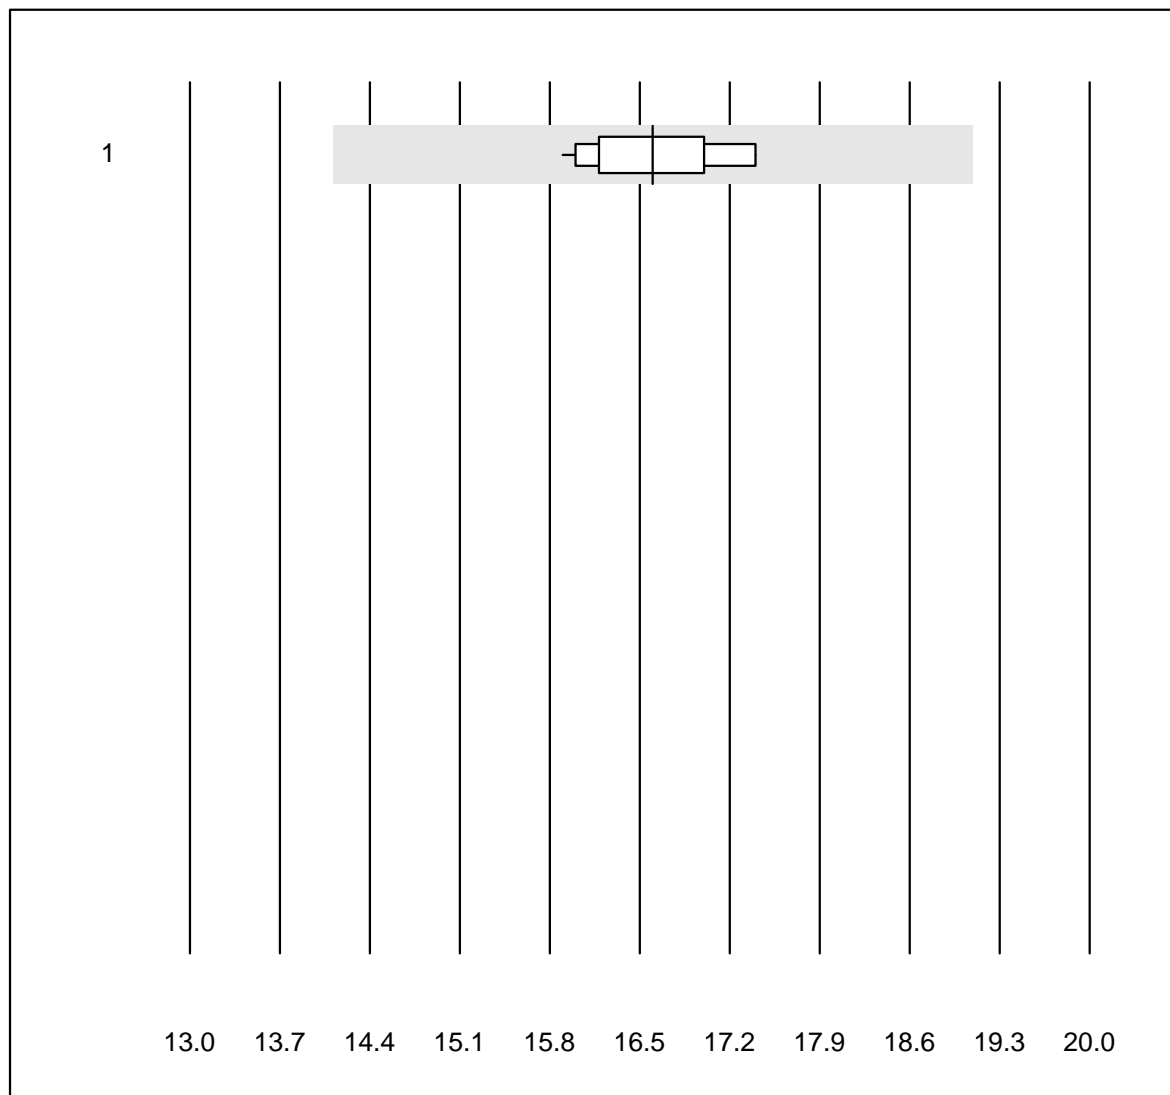


Tolérance MQ : 15 %

Phosphore-urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Efulft	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	16	100.0	0.0	0.0	16.6	3.0	e

## Potassium-urine

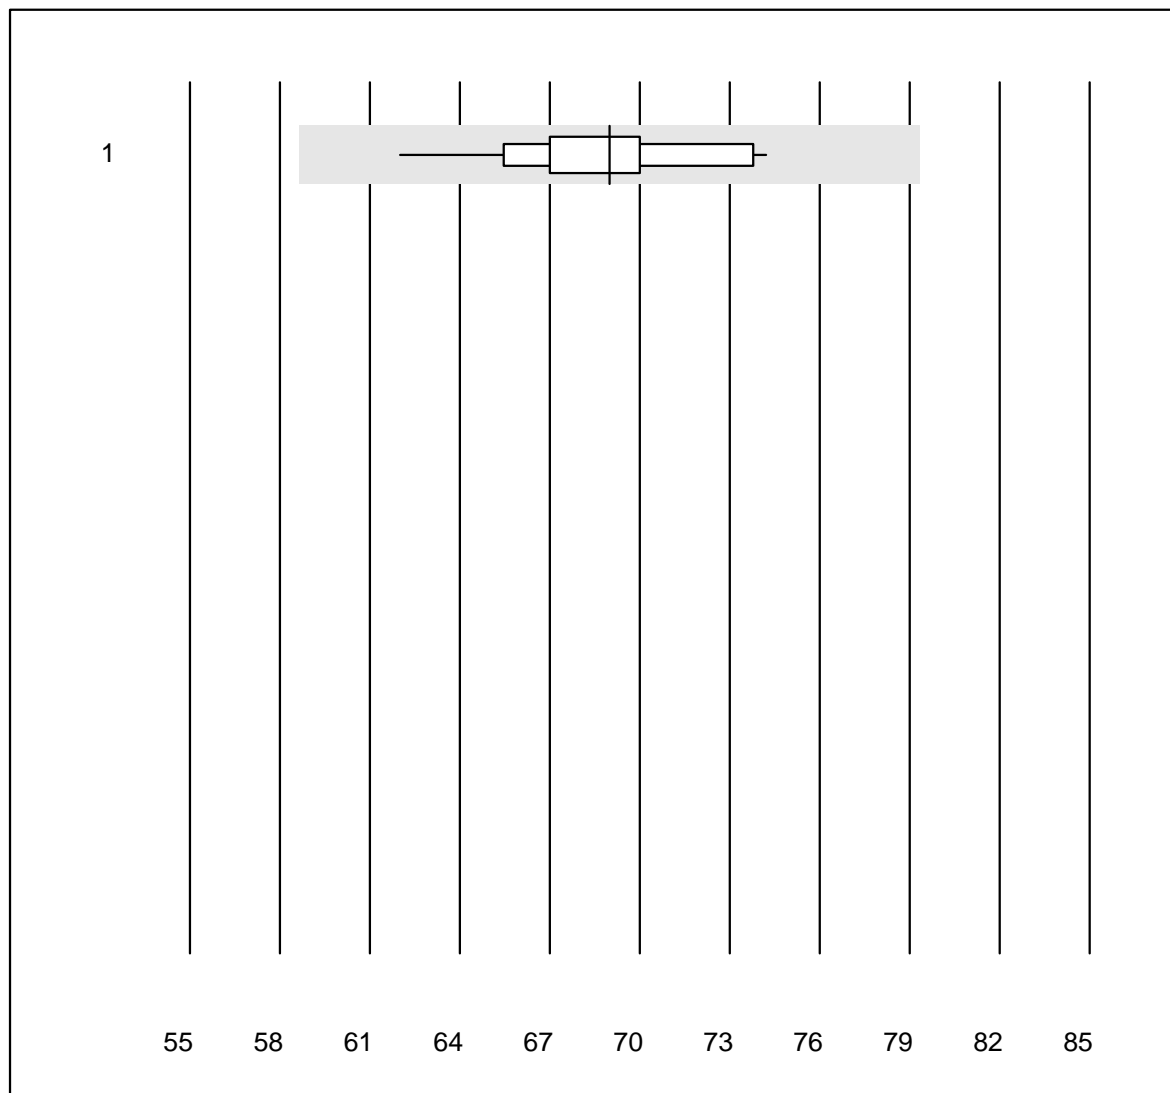


Tolérance MQ : 15 %

Potassium-urine (mmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	24	100.0	0.0	0.0	69	4.4	e

## Protéines-urine

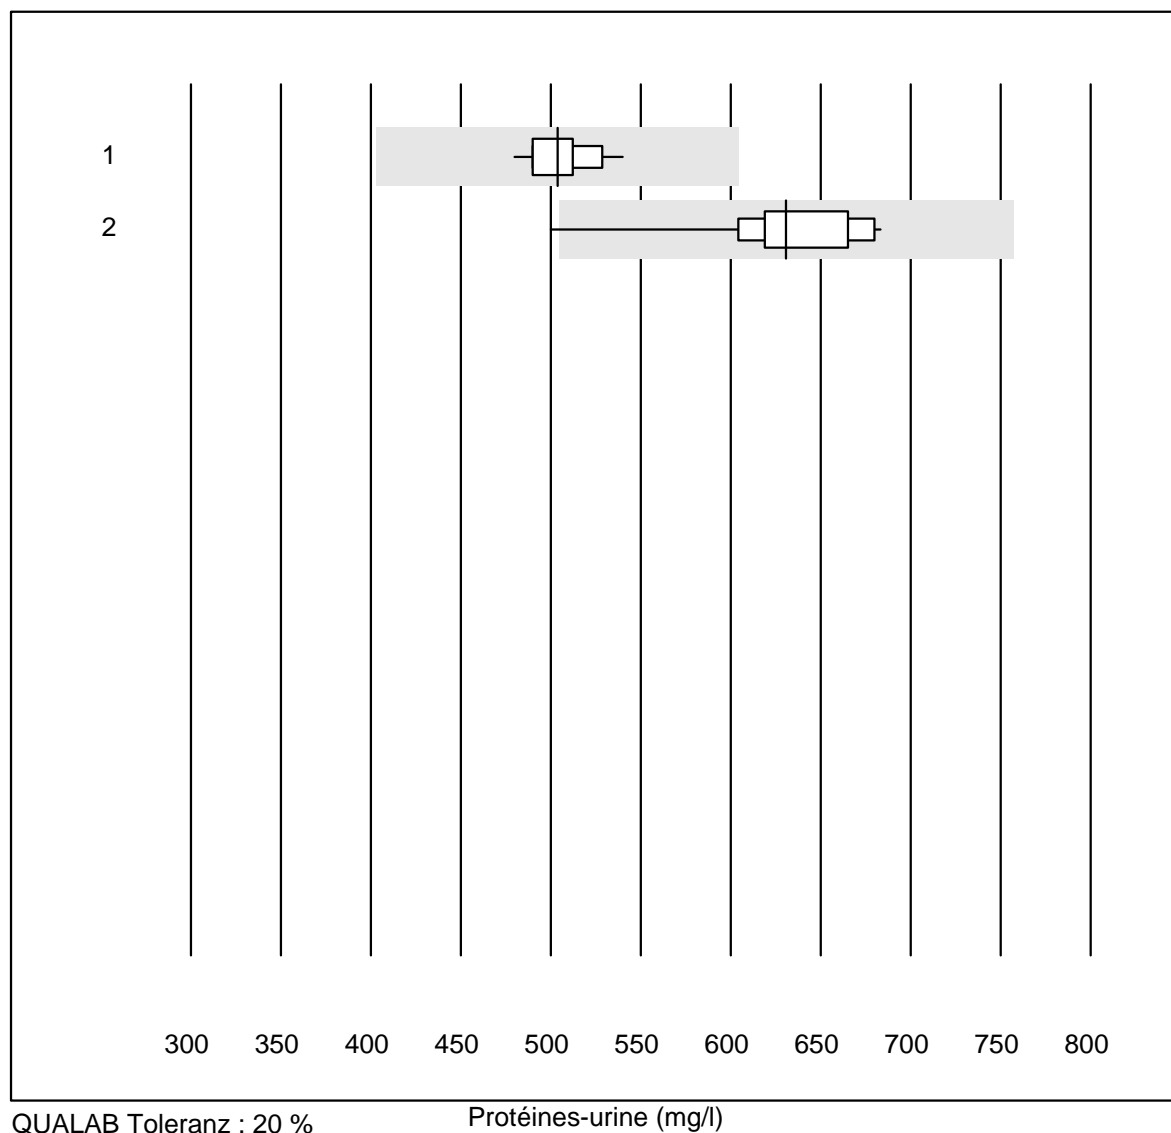

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas/Roche	15	100.0	0.0	0.0	503.8	3.3	e
2 Chimie humide	11	90.9	9.1	0.0	630.8	7.9	e

## Sodium-urine

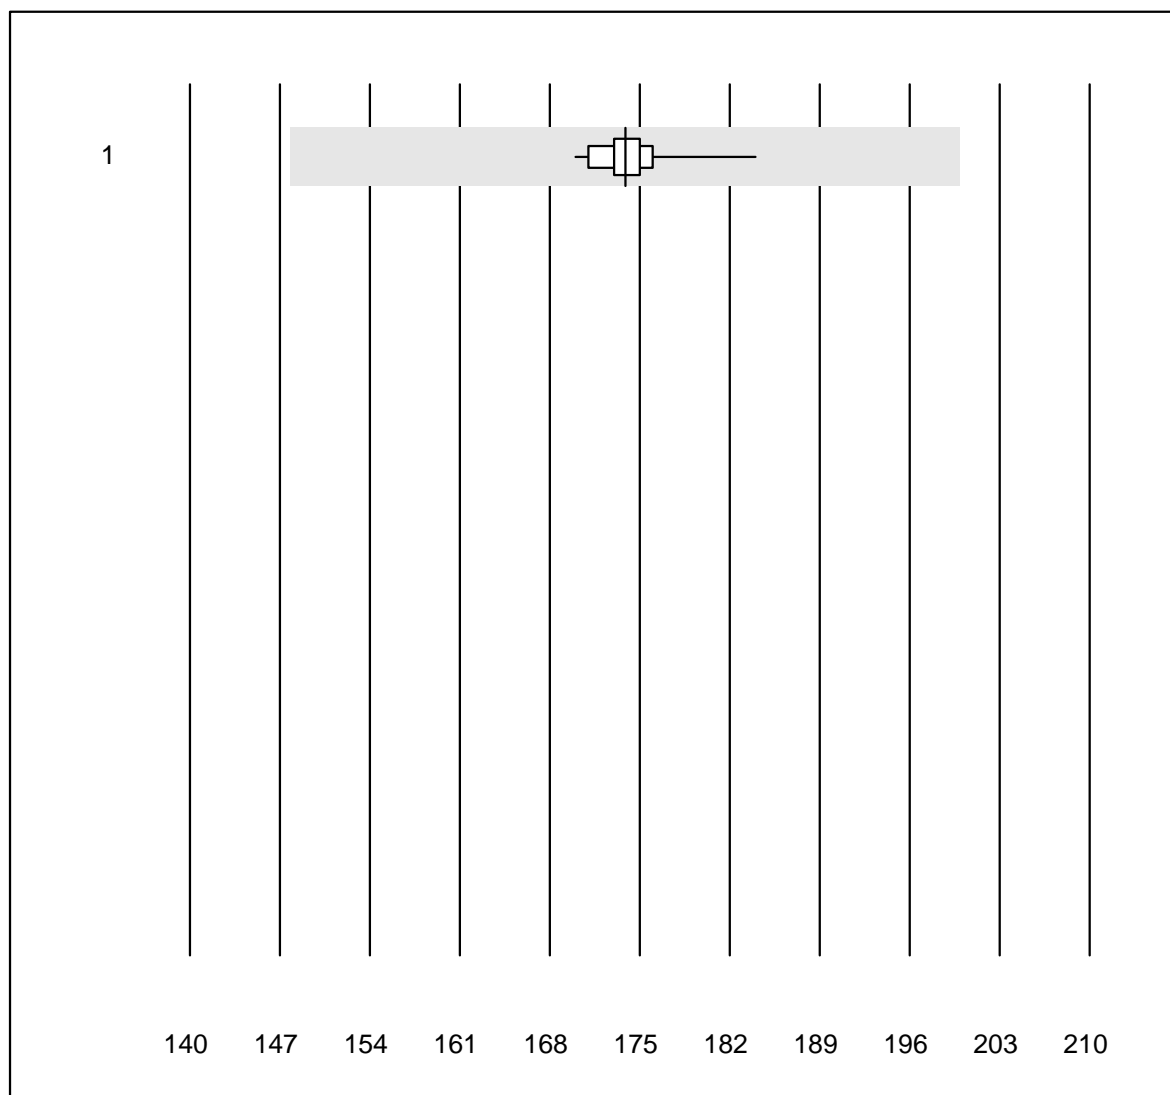


Tolérance MQ : 15 %

Sodium-urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	25	100.0	0.0	0.0	174	1.6	e

## Urée-urine

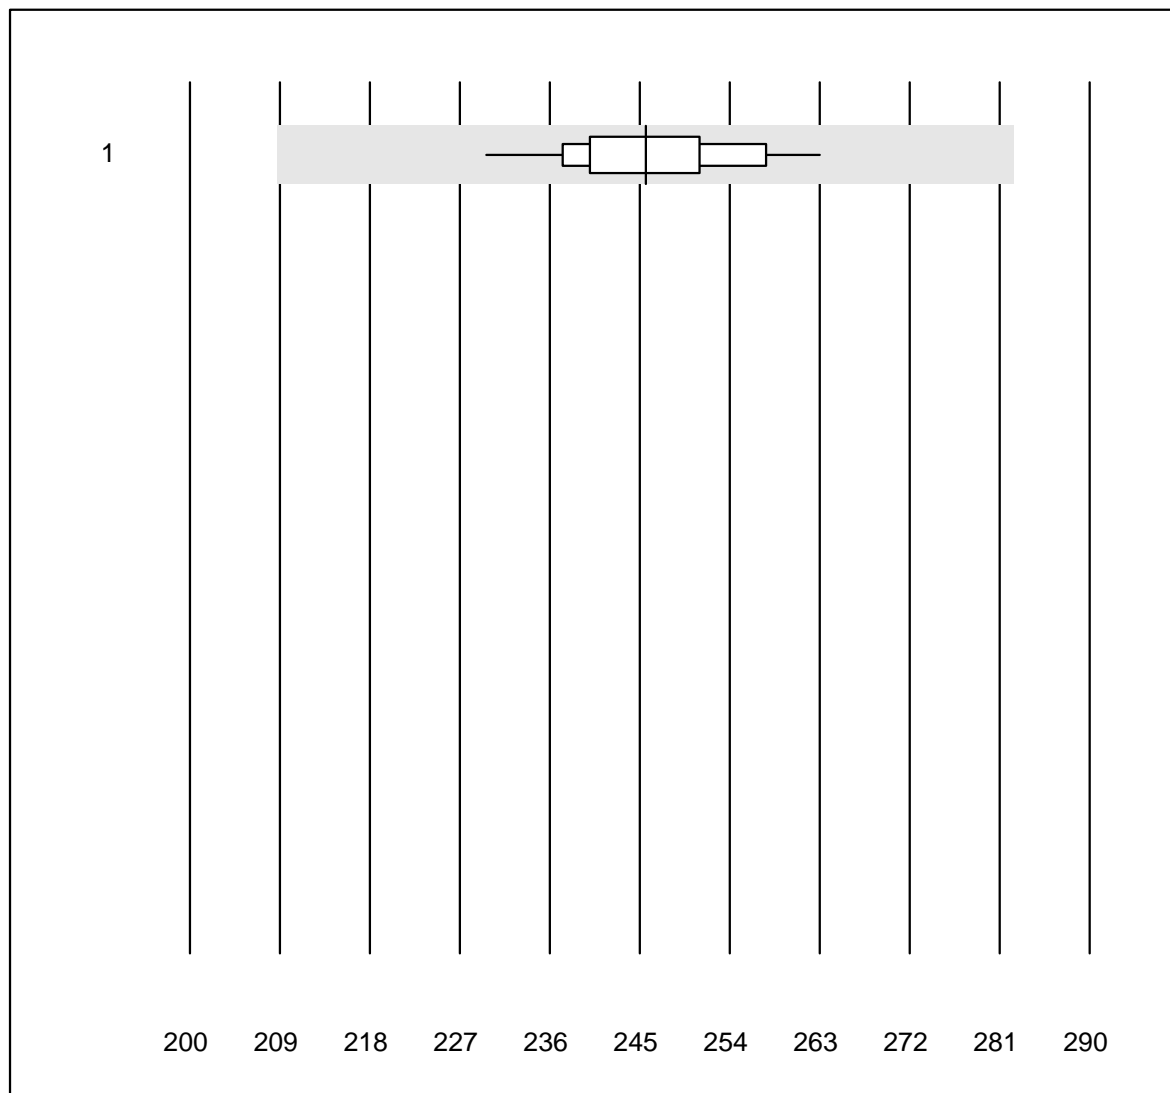


Tolérance MQ : 15 %

Urée-urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	21	100.0	0.0	0.0	246	3.7	e

## Acide urique-urine

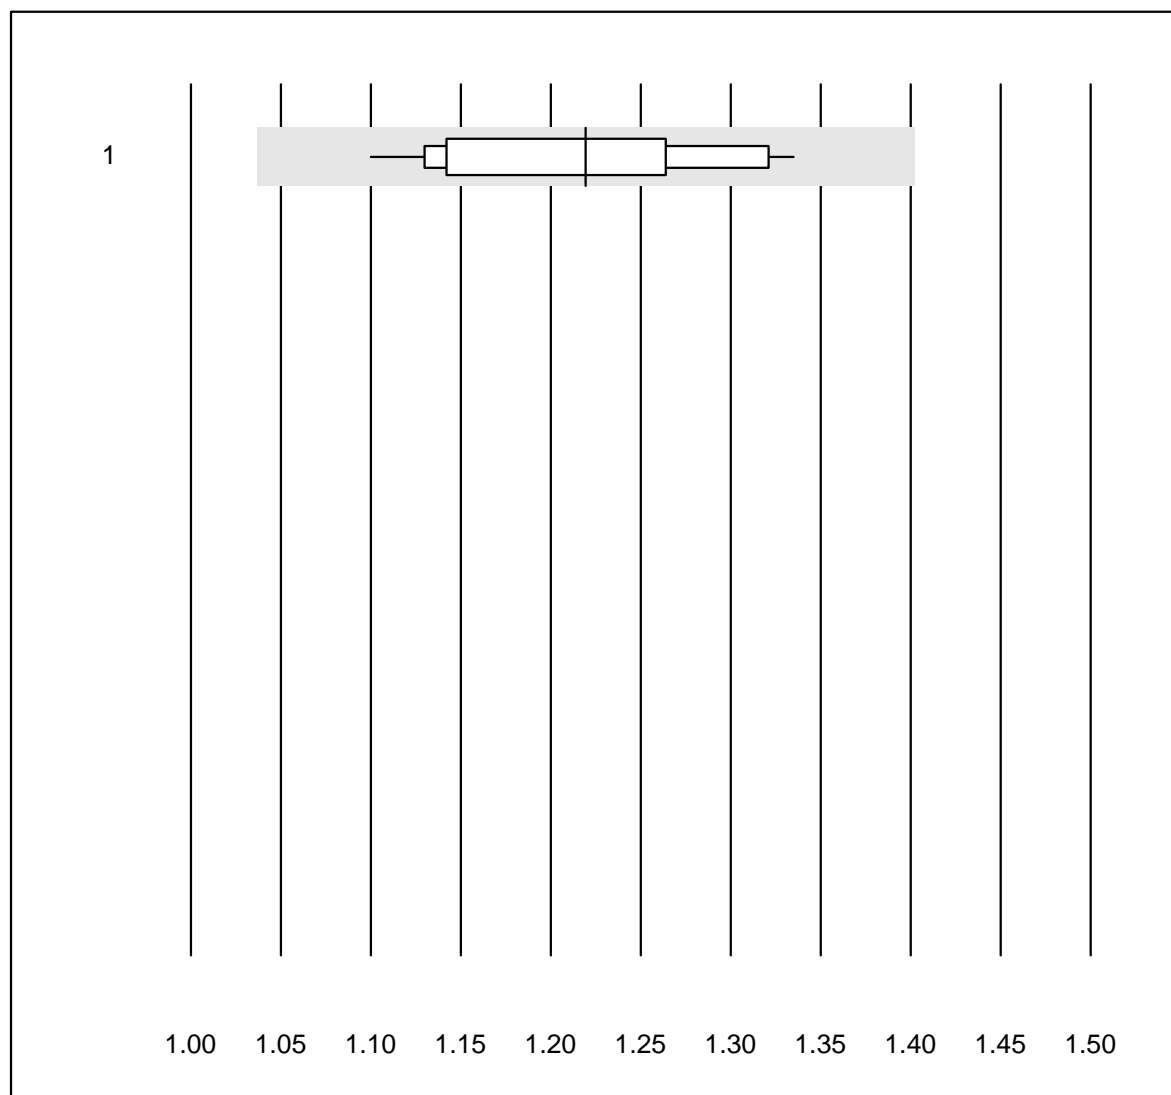


Tolérance MQ : 15 %

Acide urique-urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	16	100.0	0.0	0.0	1.22	5.7	e

## Gravité spécifique-urine

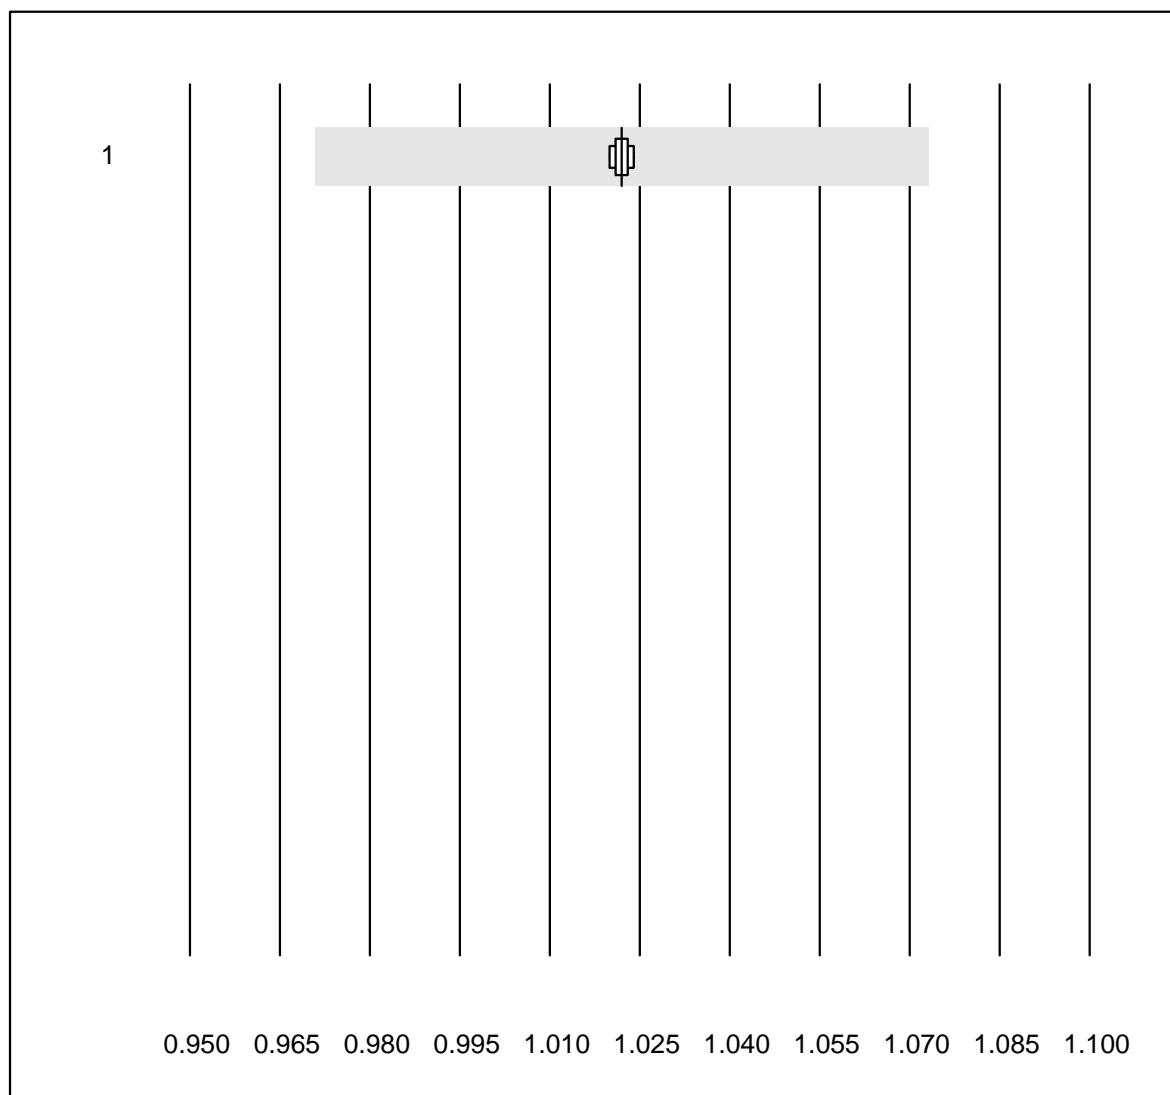


Tolérance MQ : 5 %

Gravité spécifique-urine ()

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Refraktometer	7	100.0	0.0	0.0	1.022	0.1	e


## Microalbumine

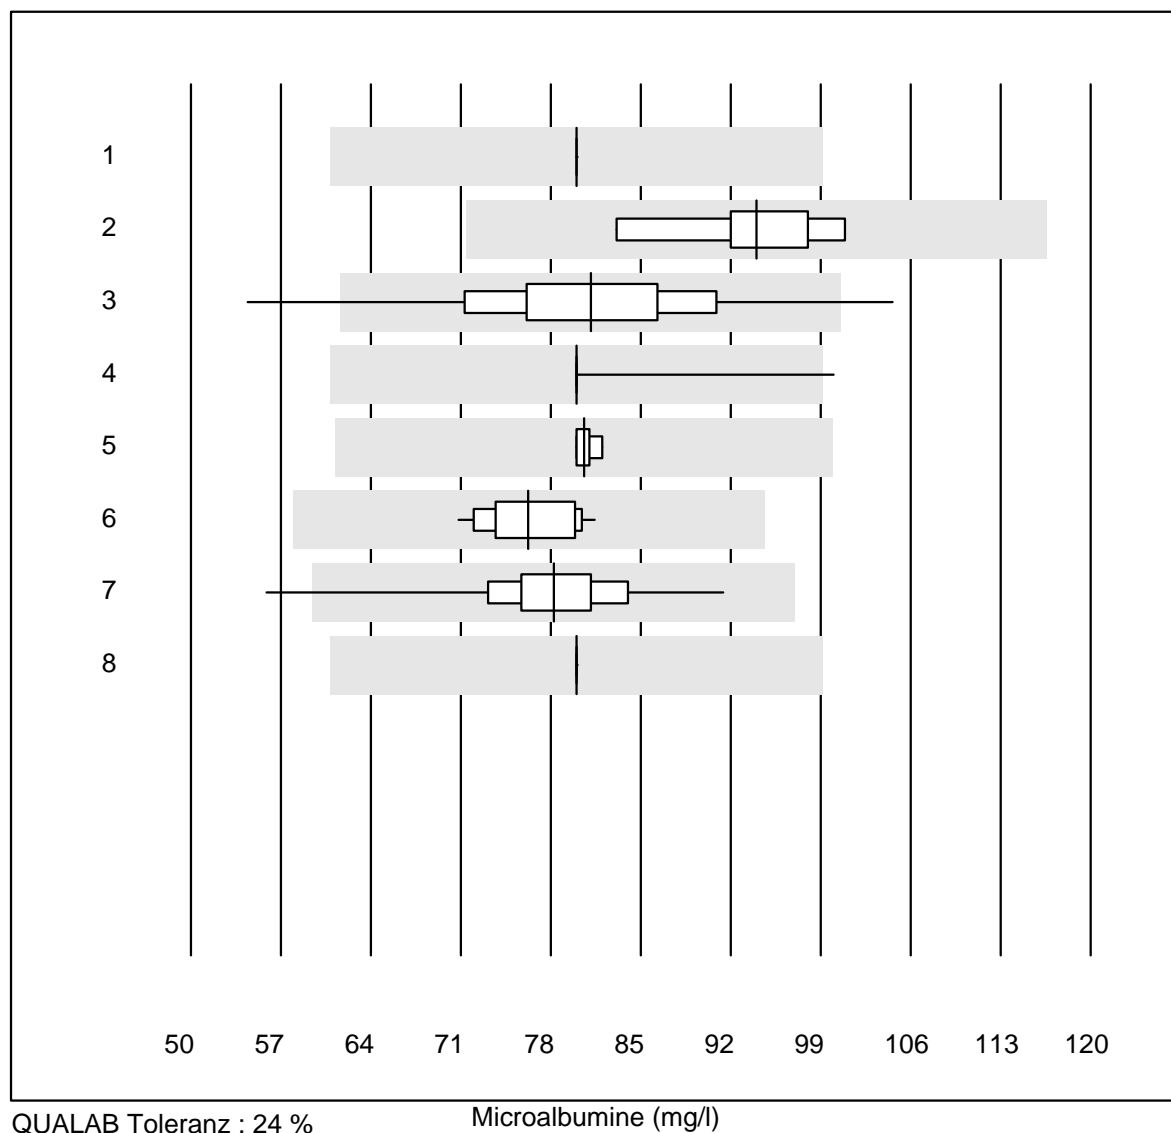

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Aution Eleven	4	25.0	0.0	75.0	80.0	0.0	a
2	AFIAS	9	100.0	0.0	0.0	94.0	5.8	e
3	Afinion	448	96.9	1.1	2.0	81.1	9.4	e
4	Sysmex U	18	66.6	5.6	27.8	80.0	6.8	a
5	Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	80.6	1.1	e
6	Turbidimetrie	25	100.0	0.0	0.0	76.3	4.4	e
7	DCA2000/Vantage	142	95.1	0.7	4.2	78.2	6.2	e
8	Siemens Clinitek	12	100.0	0.0	0.0	80.0	0.0	e



## Créatinine urine

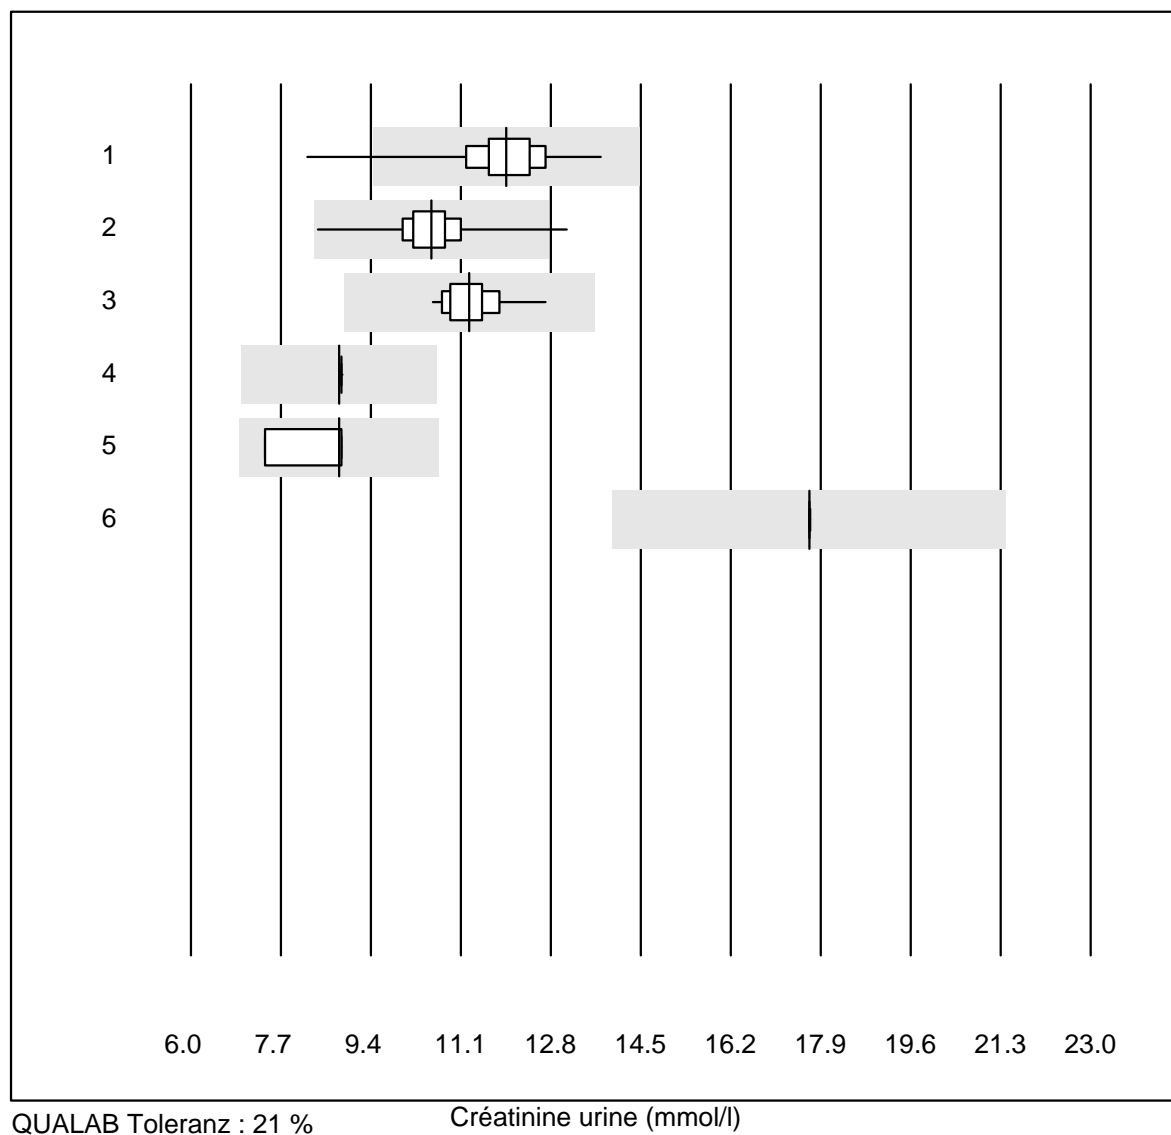

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	DCA2000/Vantage	142	90.9	2.1	7.0	12.0	6.8	e
2	Afinion	447	97.8	0.2	2.0	10.5	4.7	e
3	Chimie humide	37	100.0	0.0	0.0	11.3	4.2	e
4	Sysmex U	16	75.0	0.0	25.0	8.8	0.0	a
5	Aution Eleven	5	60.0	0.0	40.0	8.8	9.8	a
6	Siemens Clinitek	12	66.7	0.0	33.3	17.7	0.1	e