



Commentaire de l'essai interlaboratoire

2020 - 4

Échantillons de l'essai interlaboratoire

L'homogénéité et la stabilité ont été vérifiées pour tous les échantillons avant respectivement pendant l'envoi et aucune anomalie n'a été constatée. Les tests de conformité ont été réalisés par les laboratoires de l'Hôpital Universitaire de Zürich (<http://www.uzl.usz.ch/>).

Ont été produits spécifiquement pour MQ en sous-traitance les échantillons d'essai interlaboratoire suivants:

B1 Strep A Test, B2 Uricult, H4 Hématologie parasitaire, K14 Marqueur tumoral

Détermination des valeurs-cible

Pour chaque valeur-cible est indiqué le mode de détermination utilisé selon les termes de la norme ISO17043:2010, B2.1 (Colonne "Type"):

- a Valeur connue, sur la base de la production.
- b Valeur de référence certifiée lors de l'utilisation d'échantillons spécifiques
- c Valeur de référence déterminée par analyse
- d „Consensus value“ des laboratoires d'experts
- e „Consensus value“ des participants

Pour les groupes de méthode incluant plus de 9 participants, les valeurs cibles sont déterminées comme étant la „Consensus value“ ("e") des participants. Pour la détermination de ces valeurs cibles est utilisée la moyenne réalisée par le groupe de méthodes. Les résultats qui présentent un écart par rapport à la valeur cible supérieur à 1.5 fois la tolérance Qualab, sont considérés comme résultats aberrants et exclus du calcul de la valeur de référence. Les résultats des essais d'aptitude sont utilisés comme valeur de base pour éliminer les taux aberrants. Afin de mettre à disposition de tous les participants des valeurs-cible les plus pertinentes possibles, d'autres procédures peuvent également être utilisées pour des groupes de méthode plus restreints.

Incertitude dans la détermination des valeurs-cible

L'incertitude-type (u_x) est calculée à l'aide de la formule suivante (ISO13528):

$u_x = (\text{Valeur-cible}/100) * (1.25/\text{Racine carrée du "nombre des participants"}) * \text{CV en \%}$

- u_x est exprimée dans la même unité que la valeur-cible
- u_x peut être comparée avec l'écart-type du collectif des participants ($\text{Ecart-type} = \text{Valeur-cible} * \text{CV en \%} / 100$)
- Pour un nombre de participants >18 , l'incertitude-type (u_x) est significativement plus petite que la dispersion du collectif des participants et peut donc être négligée.


Tolérances QUALAB et MQ

Pour les analyses obligatoires sont utilisées les tolérances fixées par Qualab (www.qualab.ch, contrôle de qualité externe). Pour les analyses non-obligatoires, les tolérances sont fixées par le directeur de MQ pilotant l'essai interlaboratoire.

Si l'incertitude déterminée de la valeur de référence u_x est supérieure à 15% de la tolérance QUALAB ou de MQ, la lettre qui caractérise le type de détermination de la valeur-cible est en outre marquée d'une étoile (par exemple "e*"). Nous rendons ainsi les participants attentifs au fait que l'incertitude de la valeur de référence peut avoir une influence sur l'évaluation.

Représentation graphique

La représentation graphique des résultats est la suivante:

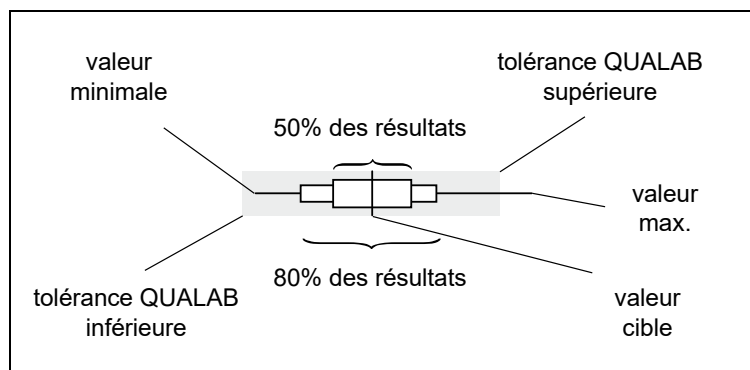


Comparaison des appareils

Les données de ce rapport vous permettent de comparer les performances respectives des divers appareils. Toutefois, vous devez tenir compte des points suivants:

- Le contrôle Chimie K1 est un sérum de contrôle commercialisé prêt à l'emploi. Même si l'échantillon est d'origine humaine, des effets matriciels sont possibles. Ceux-ci dépendent de l'appareil et peuvent générer des valeurs cible différentes.
- Seul un échantillon a été mesuré. La dispersion des résultats étant dépendante de la nature de l'échantillon (effets matriciels) et du niveau du résultat, les coefficients de variation déterminés (CV en %) ne sont pas toujours valables.
- Une grande partie des taux aberrants est due à des erreurs administratives (erreur d'unité, confusion des résultats) ou à des erreurs de manipulation (erreur d'échantillon, dissolution incorrecte, mélange insuffisant) et n'a rien à voir avec le type d'appareil.


Zürich, 6.12.2020



Dr. R. Fried
Directeur de l'essai interlaboratoire

Il n'est pas autorisé de publier une partie ou l'intégralité de ce rapport sans notre accord écrit préalable. L'original est conservé dans les archives sous www.mqzh.ch.

Quick OA

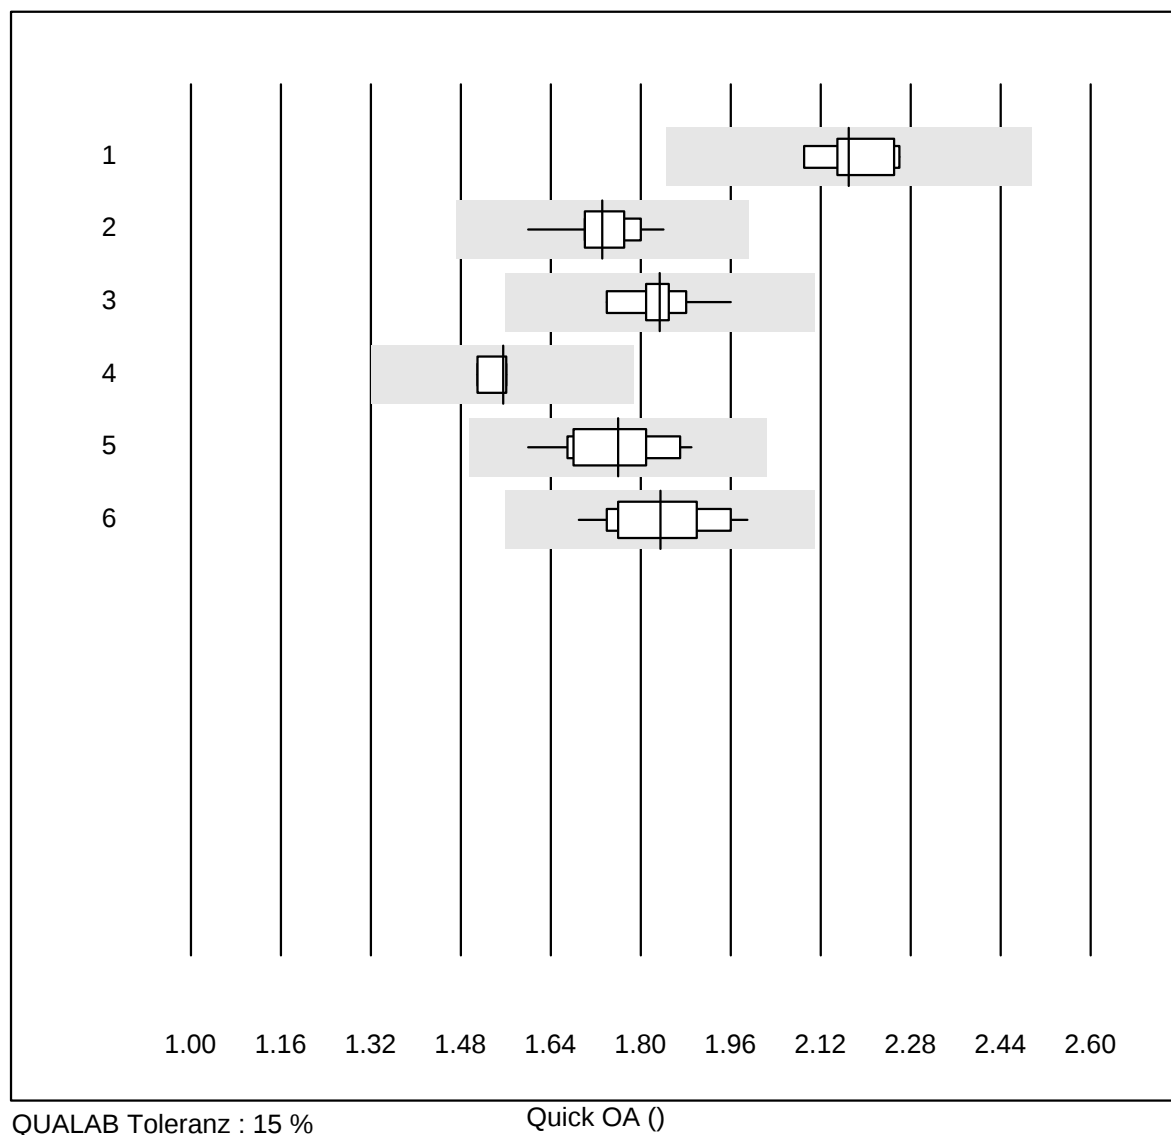


QUALAB Toleranz : 15 %


Quick OA ()

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Neoplastin Plus	5	100.0	0.0	0.0	2.17	3.3	e
2	Innovin	14	100.0	0.0	0.0	1.73	3.4	e
3	Recombiplastin 2G	10	100.0	0.0	0.0	1.83	3.1	e
4	Eurolyser	4	75.0	0.0	25.0	1.56	1.7	e
5	Autres méthodes	12	100.0	0.0	0.0	1.76	4.8	e
6	Neoplastin R	11	100.0	0.0	0.0	1.83	5.1	e

Fibrinogène OA

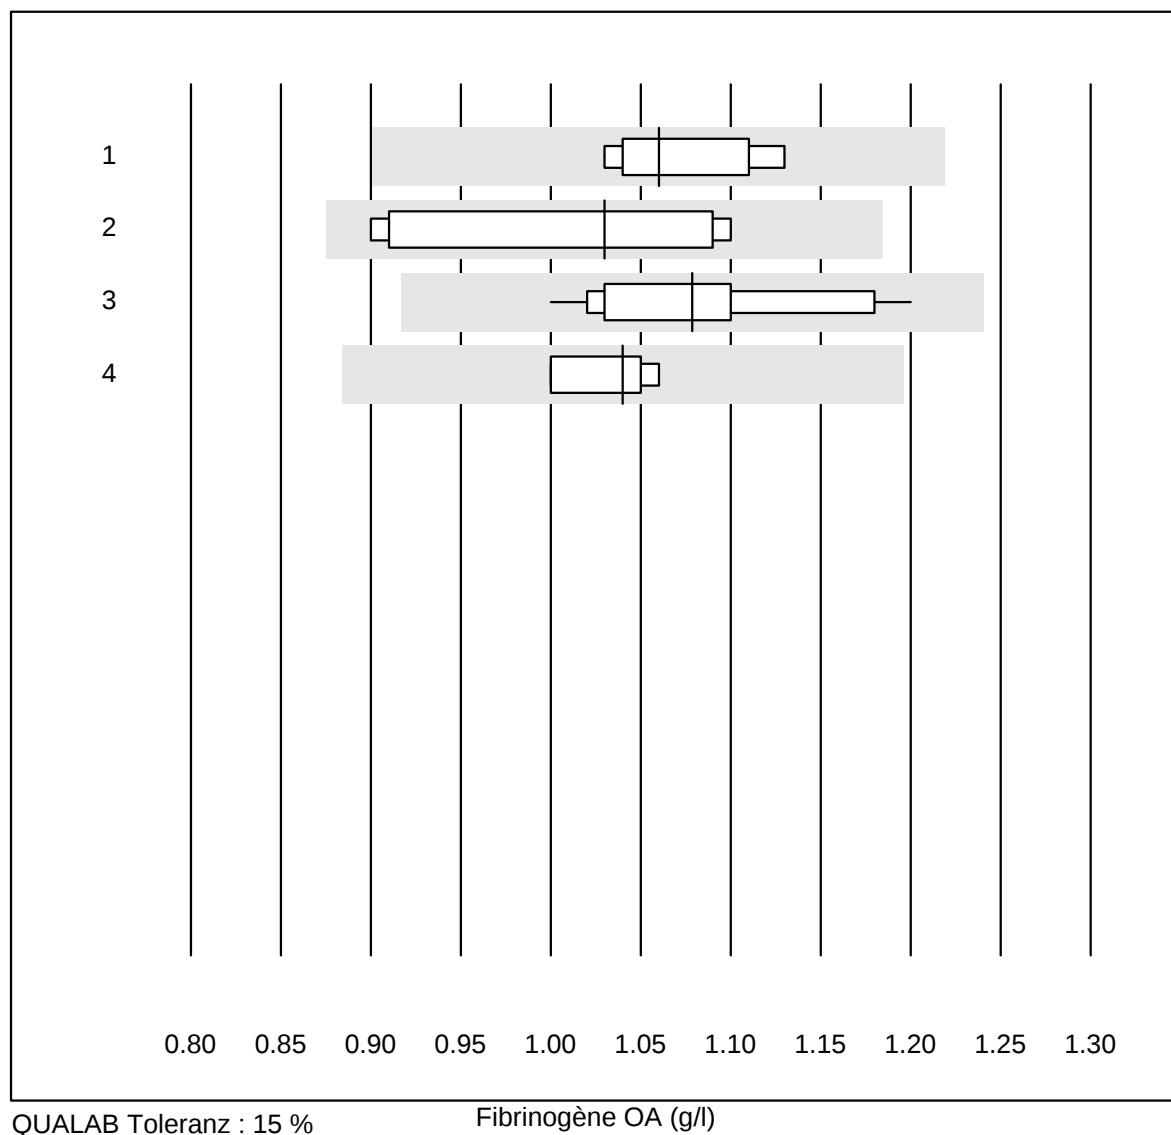


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Autres méthodes	7	100.0	0.0	0.0	1.06	3.4	e
2	Siemens Thrombin	6	100.0	0.0	0.0	1.03	8.9	e*
3	Stago/STA	13	100.0	0.0	0.0	1.08	5.5	e
4	Fibrinogen Q.F.A.	4	100.0	0.0	0.0	1.04	2.6	e

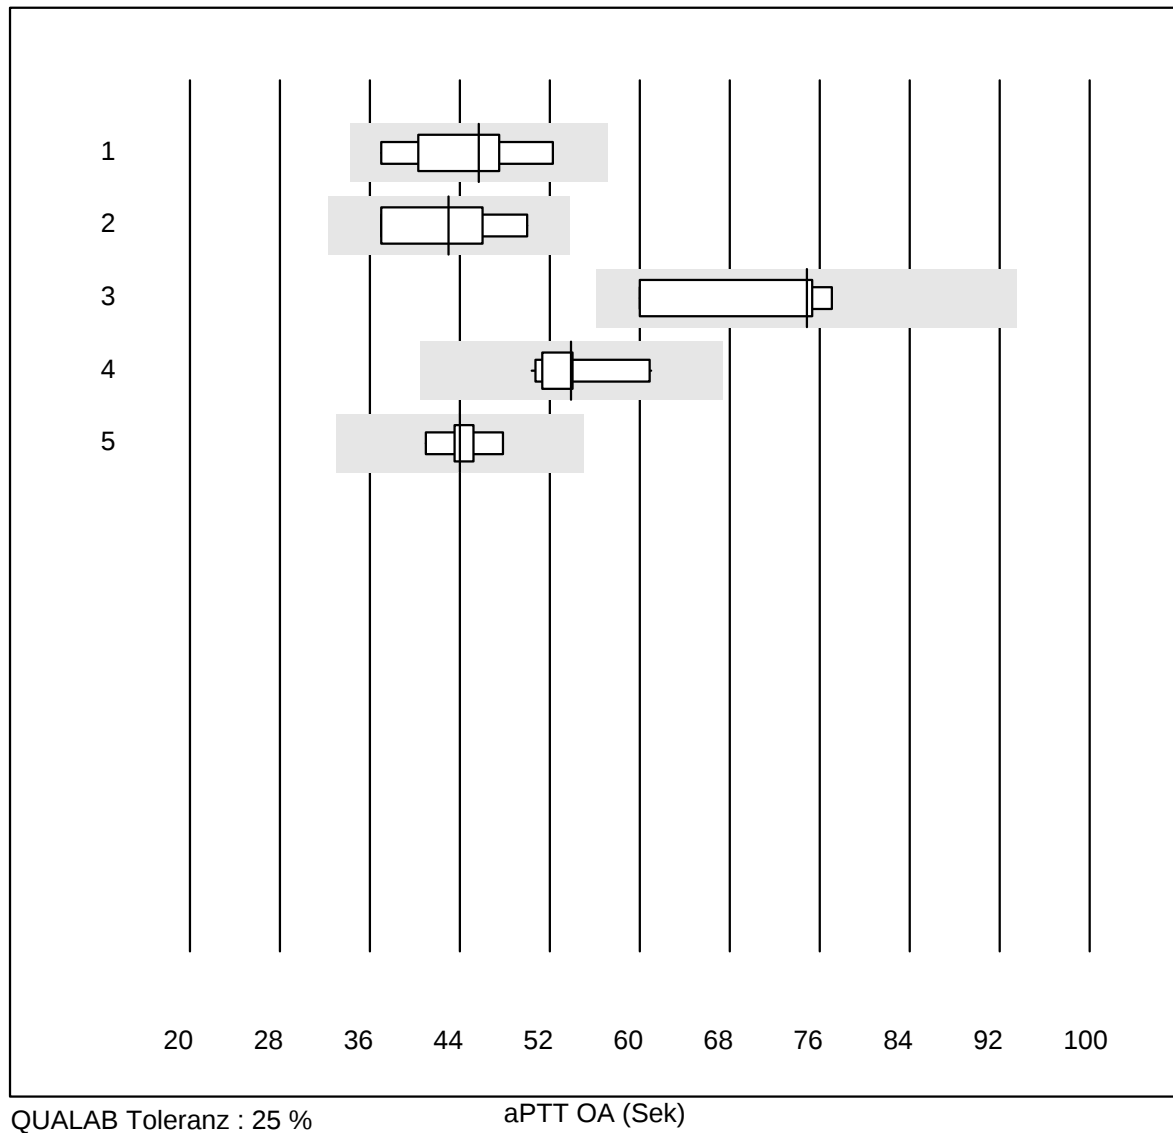aPTT OA


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Autres méthodes	9	100.0	0.0	0.0	45.7	11.7	e*
2	Actin FS	8	100.0	0.0	0.0	43.0	11.3	e*
3	Pathromtin SL	4	100.0	0.0	0.0	74.9	11.0	e*
4	Stago/STA	13	100.0	0.0	0.0	53.9	6.9	e
5	aPTT-SP	5	100.0	0.0	0.0	44.0	5.6	e

INR CoaguChek

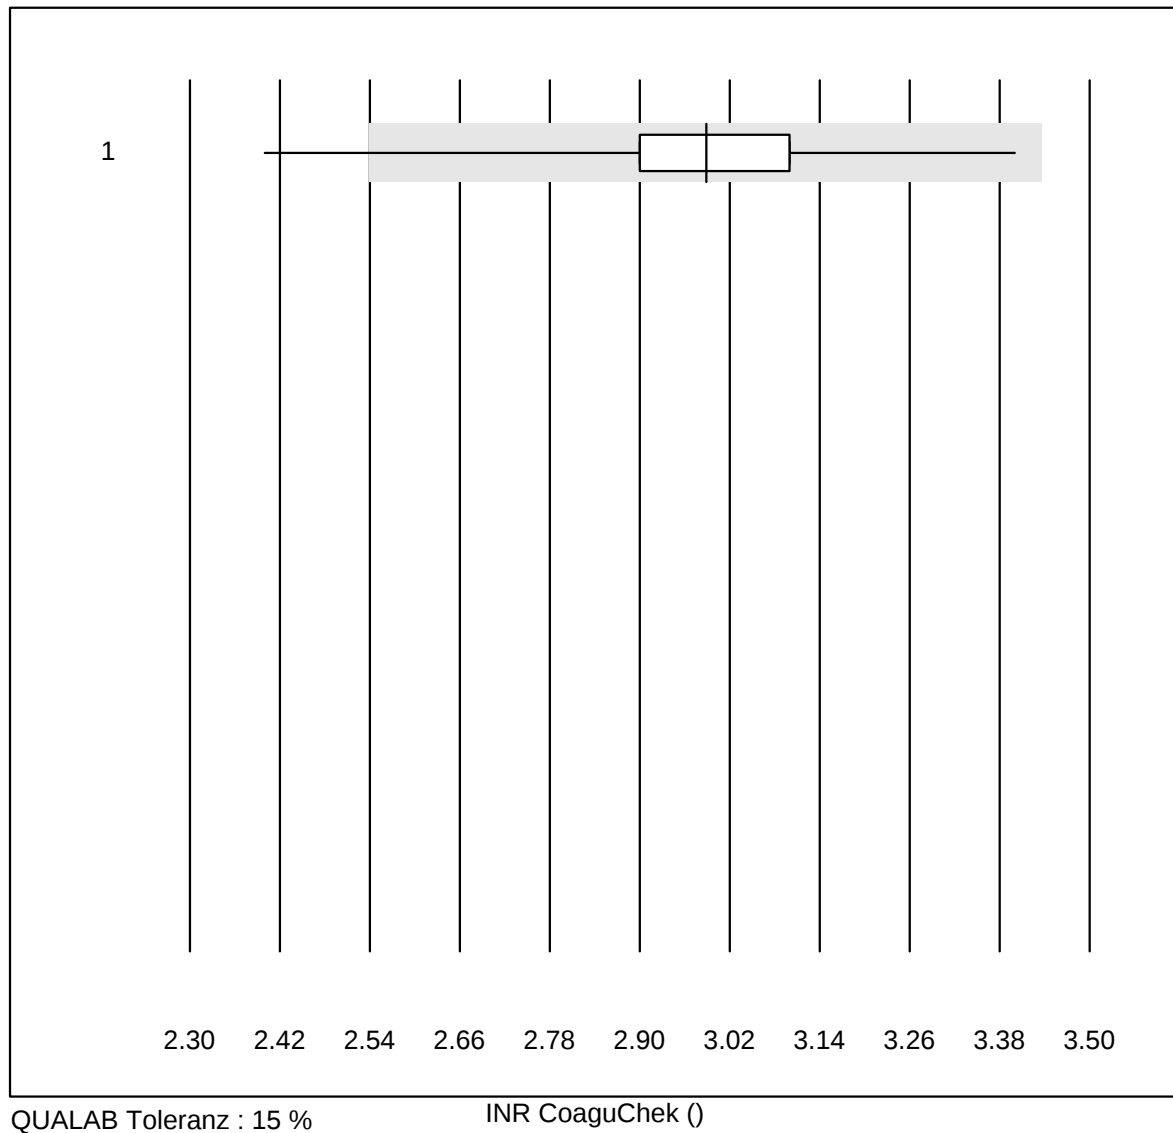


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	CoaguChek Pro II	576	99.2	0.3	0.5	3.0	3.6	e

Quick N

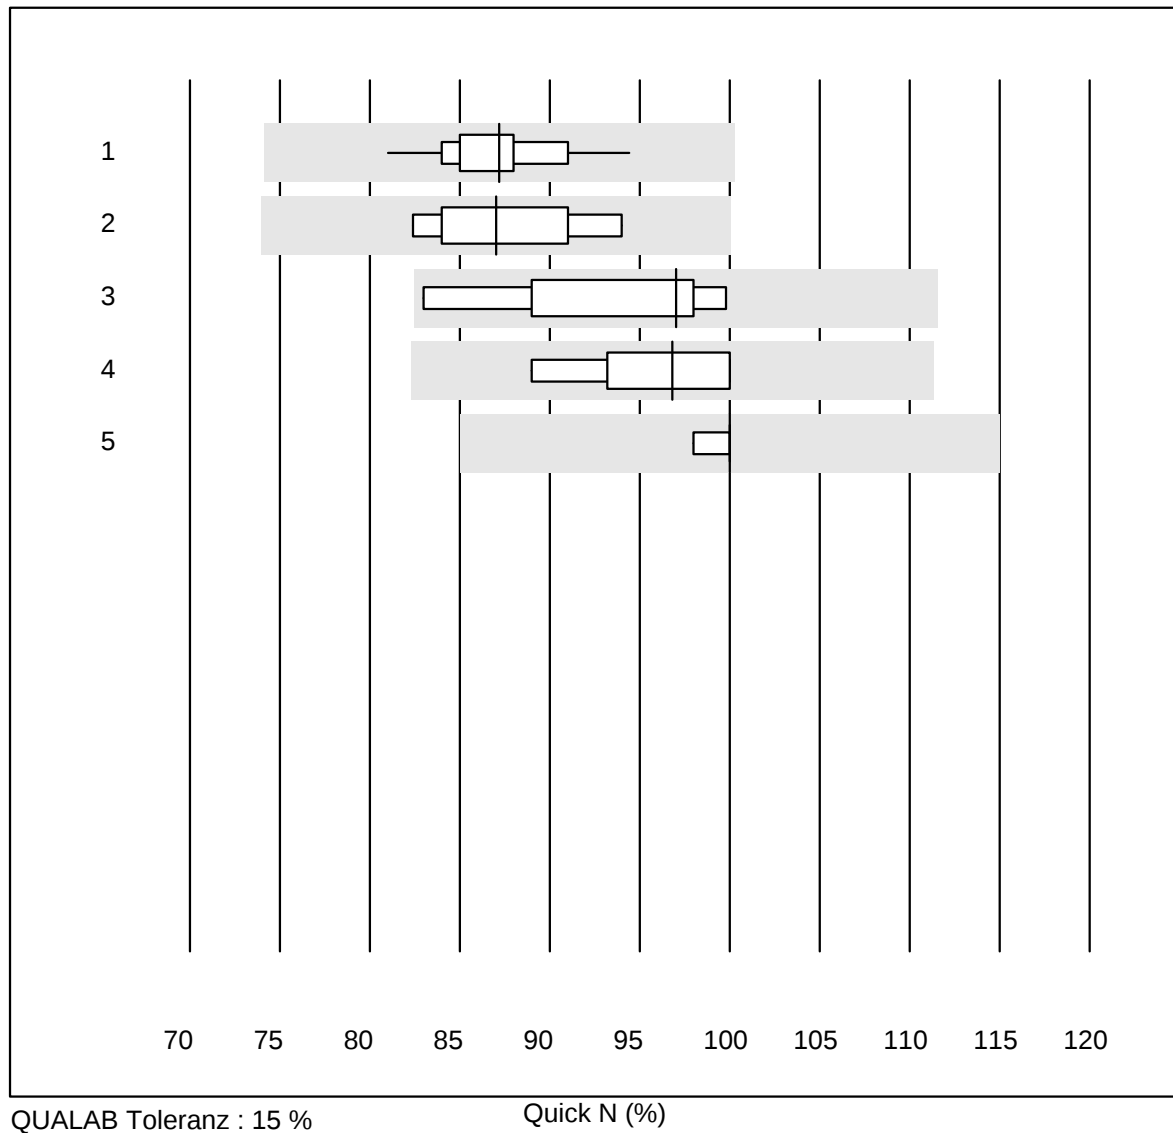


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Neoplastin R	13	100.0	0.0	0.0	87	3.9	e
2	Neoplastin Plus	6	100.0	0.0	0.0	87	5.0	e*
3	Innovin	9	100.0	0.0	0.0	97	6.3	e*
4	toutes les méthodes	10	100.0	0.0	0.0	97	4.4	e
5	Recombiplastin 2G	7	85.7	0.0	14.3	100	0.8	e

Faktor II

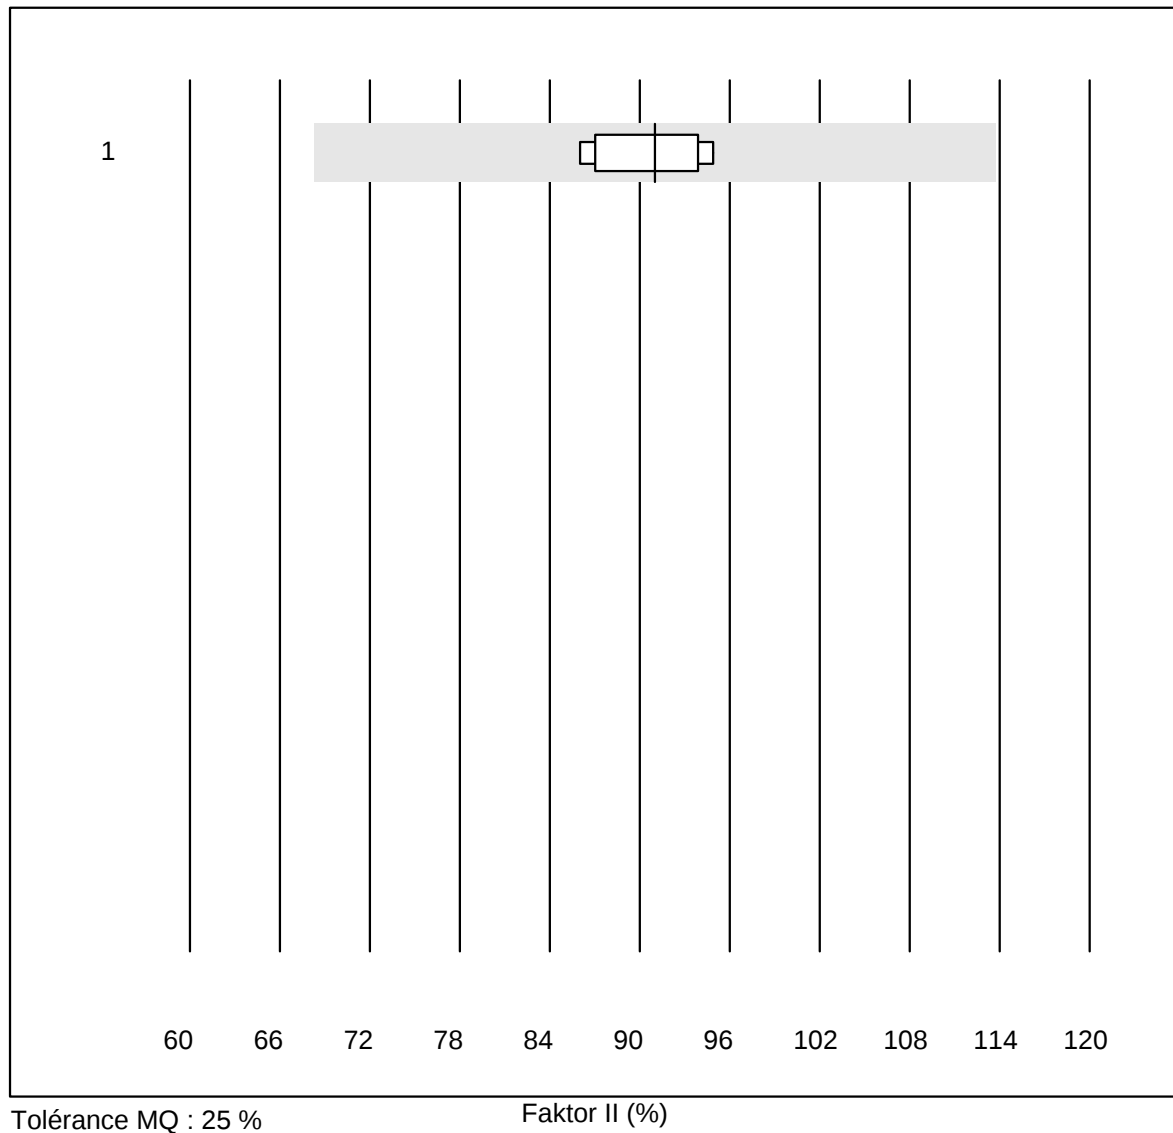


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	91.0	4.4	e

Fibrinogen N

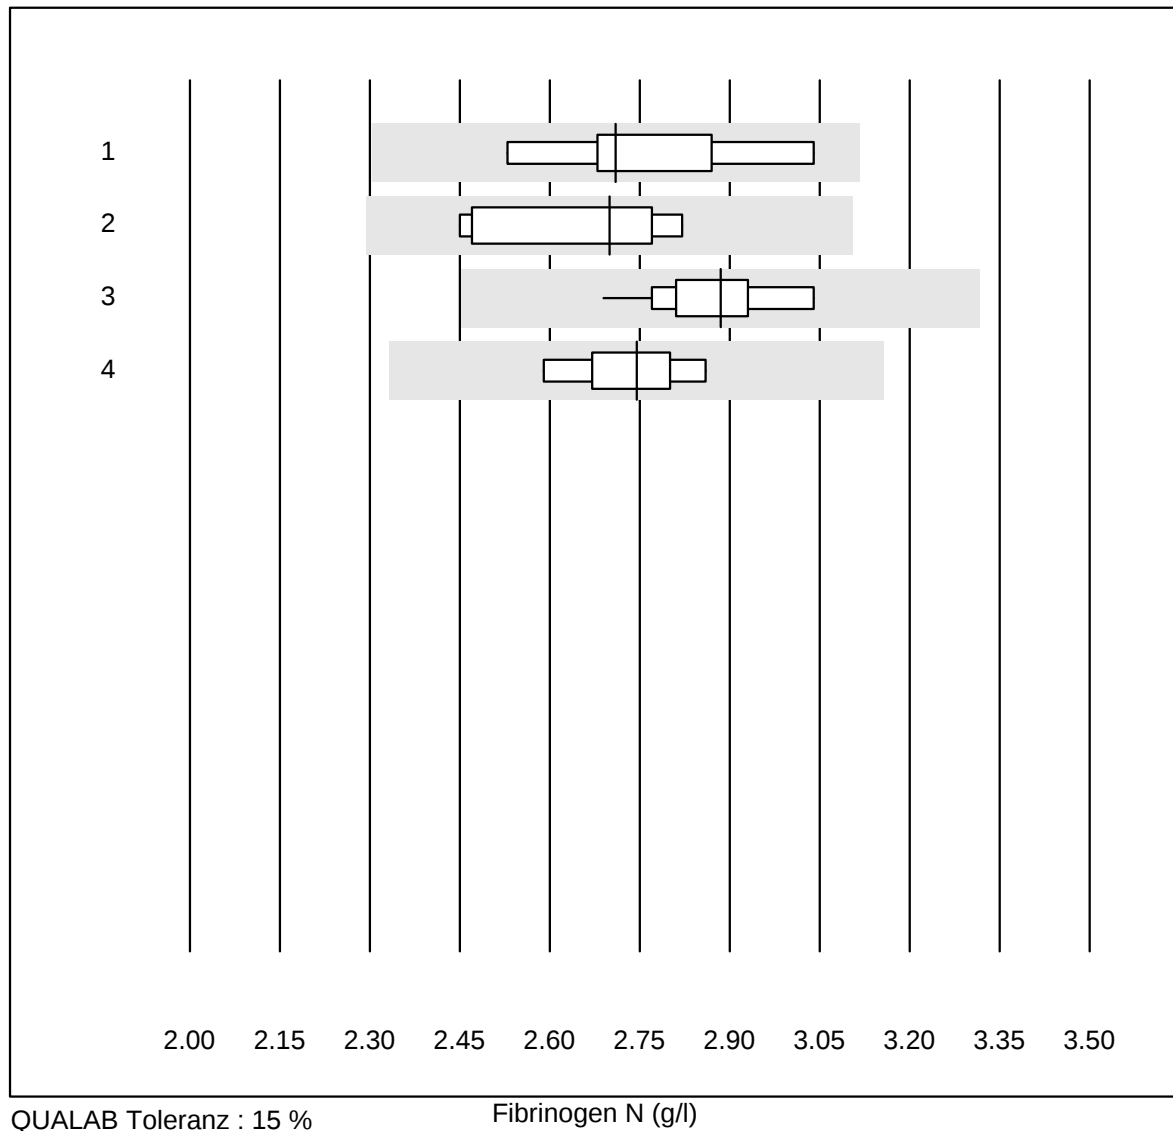


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Siemens Thrombin	7	100.0	0.0	0.0	2.71	5.9	e*
2	Autres méthodes	6	100.0	0.0	0.0	2.70	6.0	e*
3	Stago/STA	17	94.1	0.0	5.9	2.89	3.4	e
4	Fibrinogen Q.F.A.	6	100.0	0.0	0.0	2.75	3.6	e

Faktor V

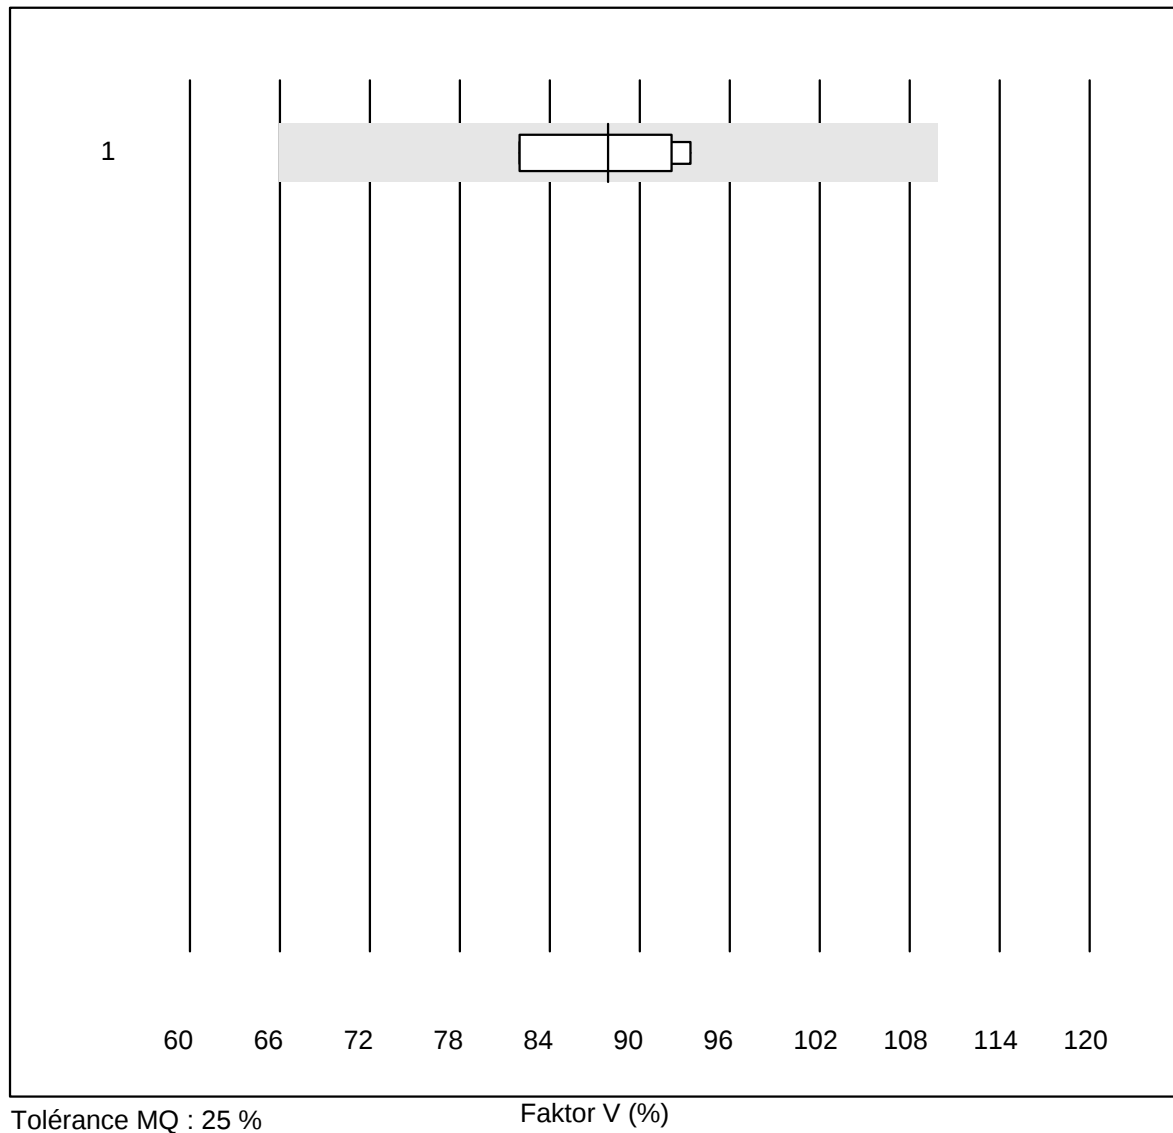


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	87.9	5.3	e

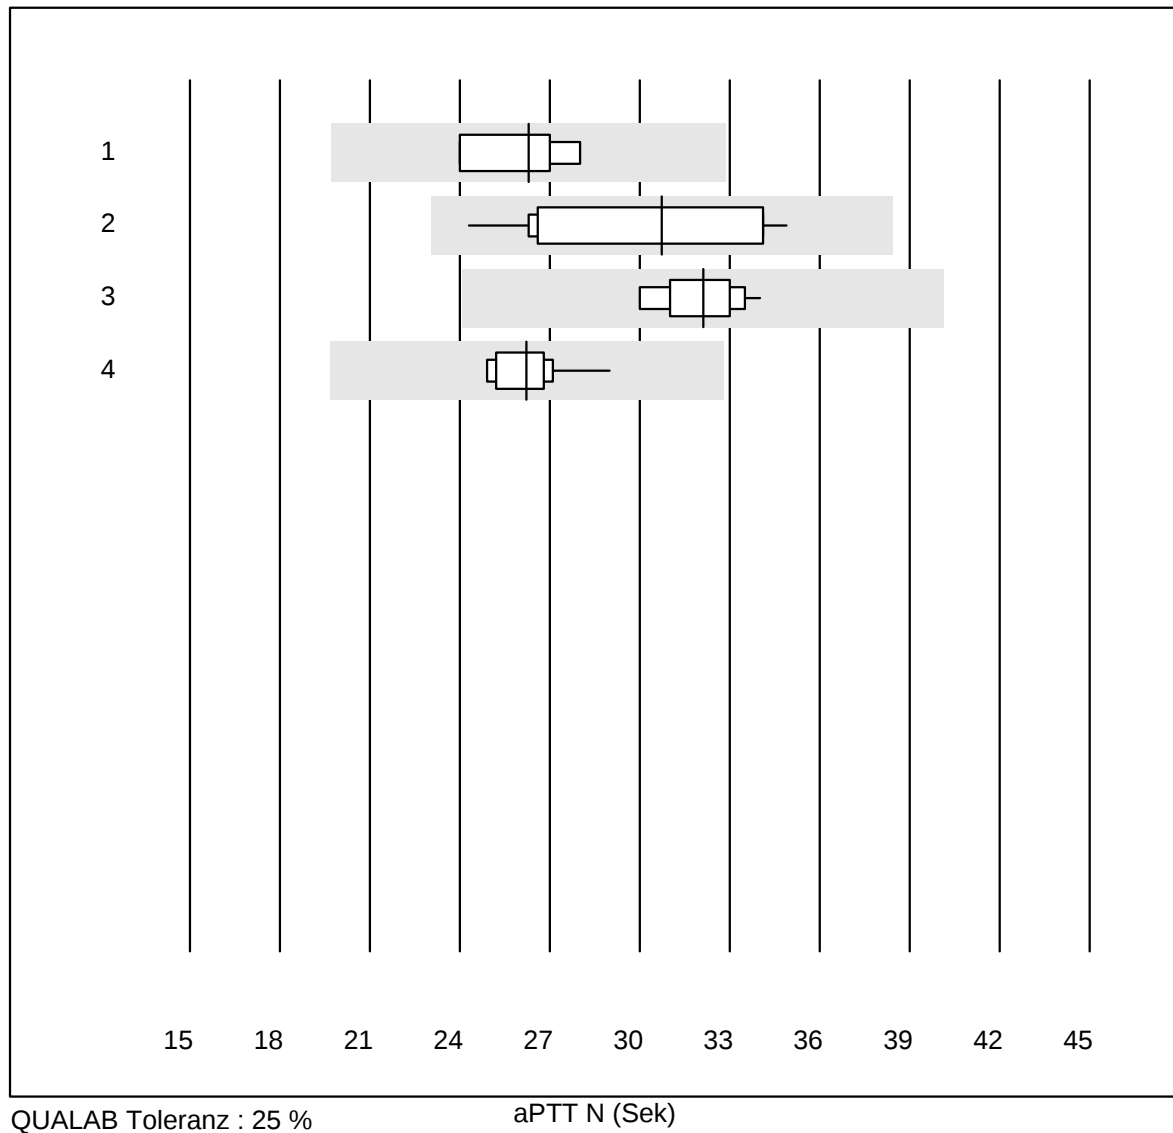aPTT N

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Actin FS	4	100.0	0.0	0.0	26.3	6.6	e*
2	Autres méthodes	11	100.0	0.0	0.0	30.7	12.4	e*
3	Stago/STA	16	100.0	0.0	0.0	32.1	3.7	e
4	aPTT-SP	10	100.0	0.0	0.0	26.2	4.7	e

Faktor VII

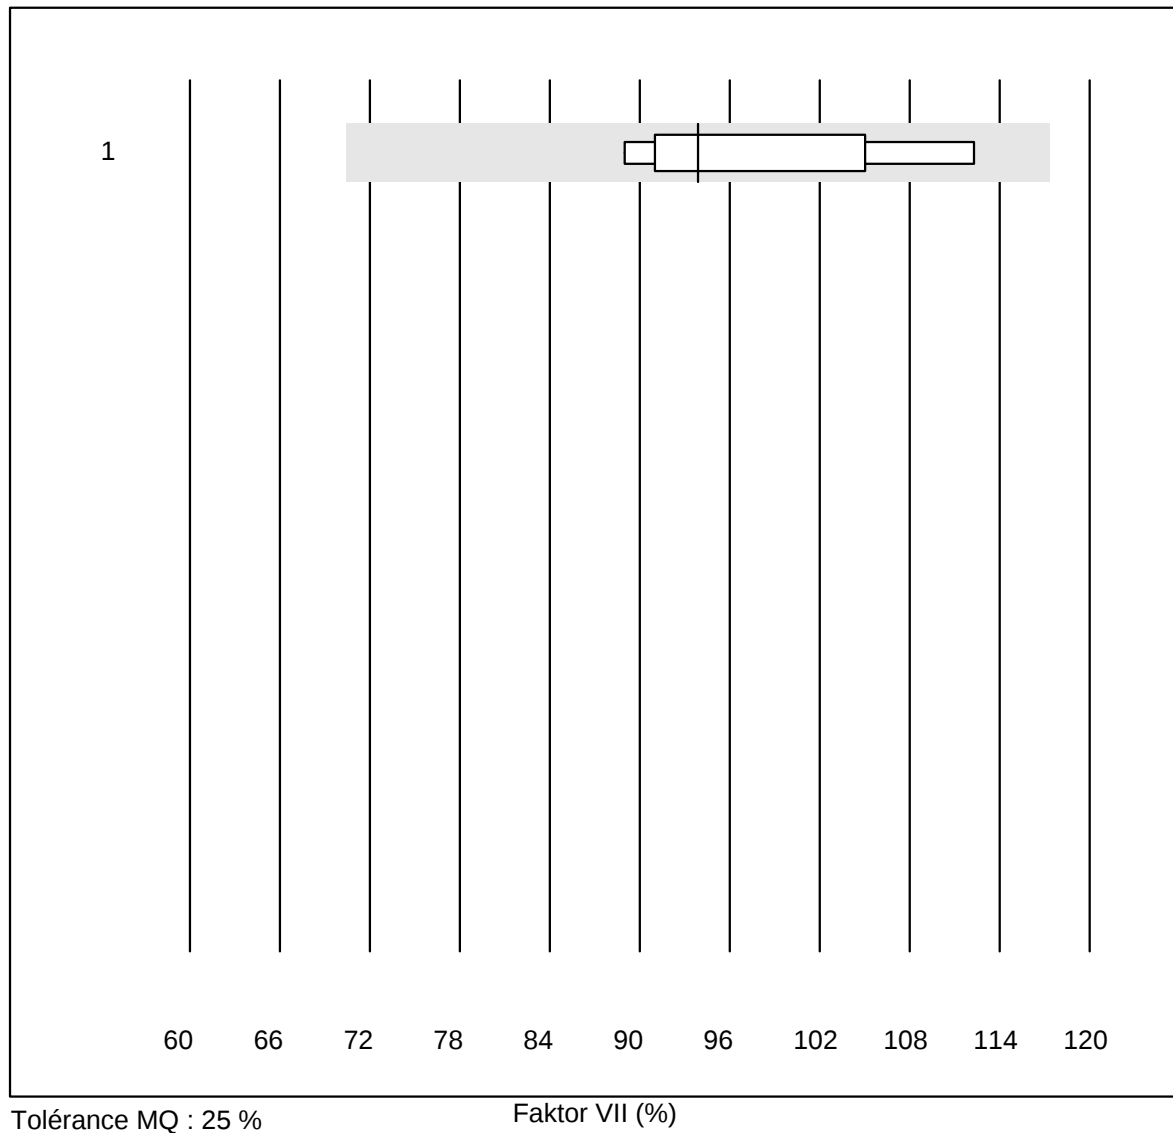


Tolérance MQ : 25 %

Faktor VII (%)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	93.9	9.4	e*

Quick H

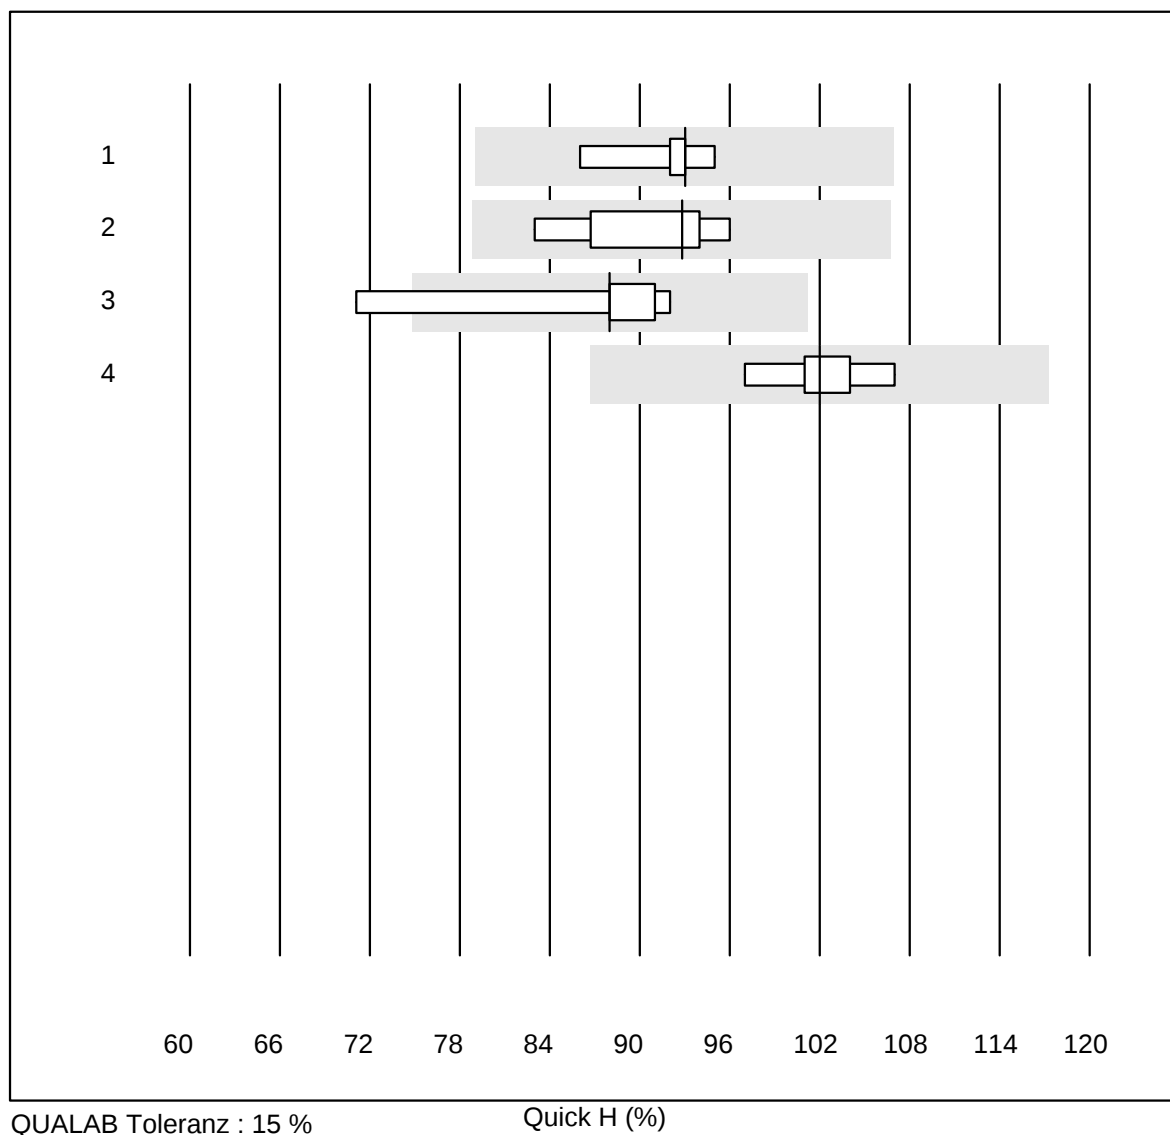

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Neoplastin R	9	100.0	0.0	0.0	93	2.9	e
2	Innovin	9	100.0	0.0	0.0	93	5.4	e*
3	toutes les méthodes	5	80.0	20.0	0.0	88	9.9	e*
4	Recombiplastin 2G	9	100.0	0.0	0.0	102	3.2	e

Anti-FXa (unfrakt-Heparin)

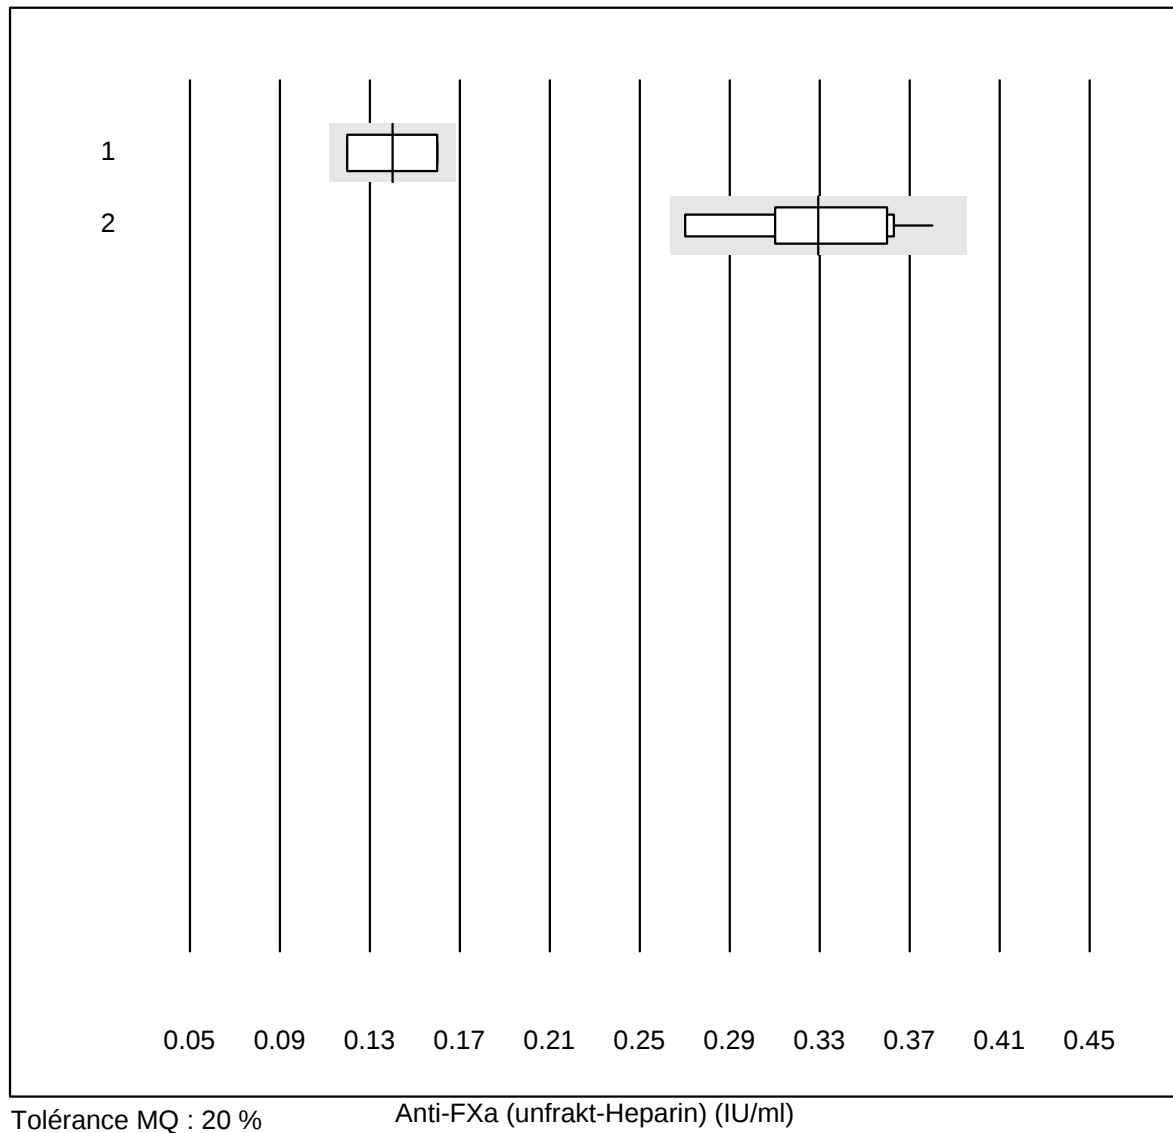


Tolérance MQ : 20 %

Anti-FXa (unfrakt-Heparin) (IU/ml)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Stago/STA	4	100.0	0.0	0.0	0.14	12.8	a
2	ACL	10	100.0	0.0	0.0	0.33	10.5	e*


Fibrinogen H

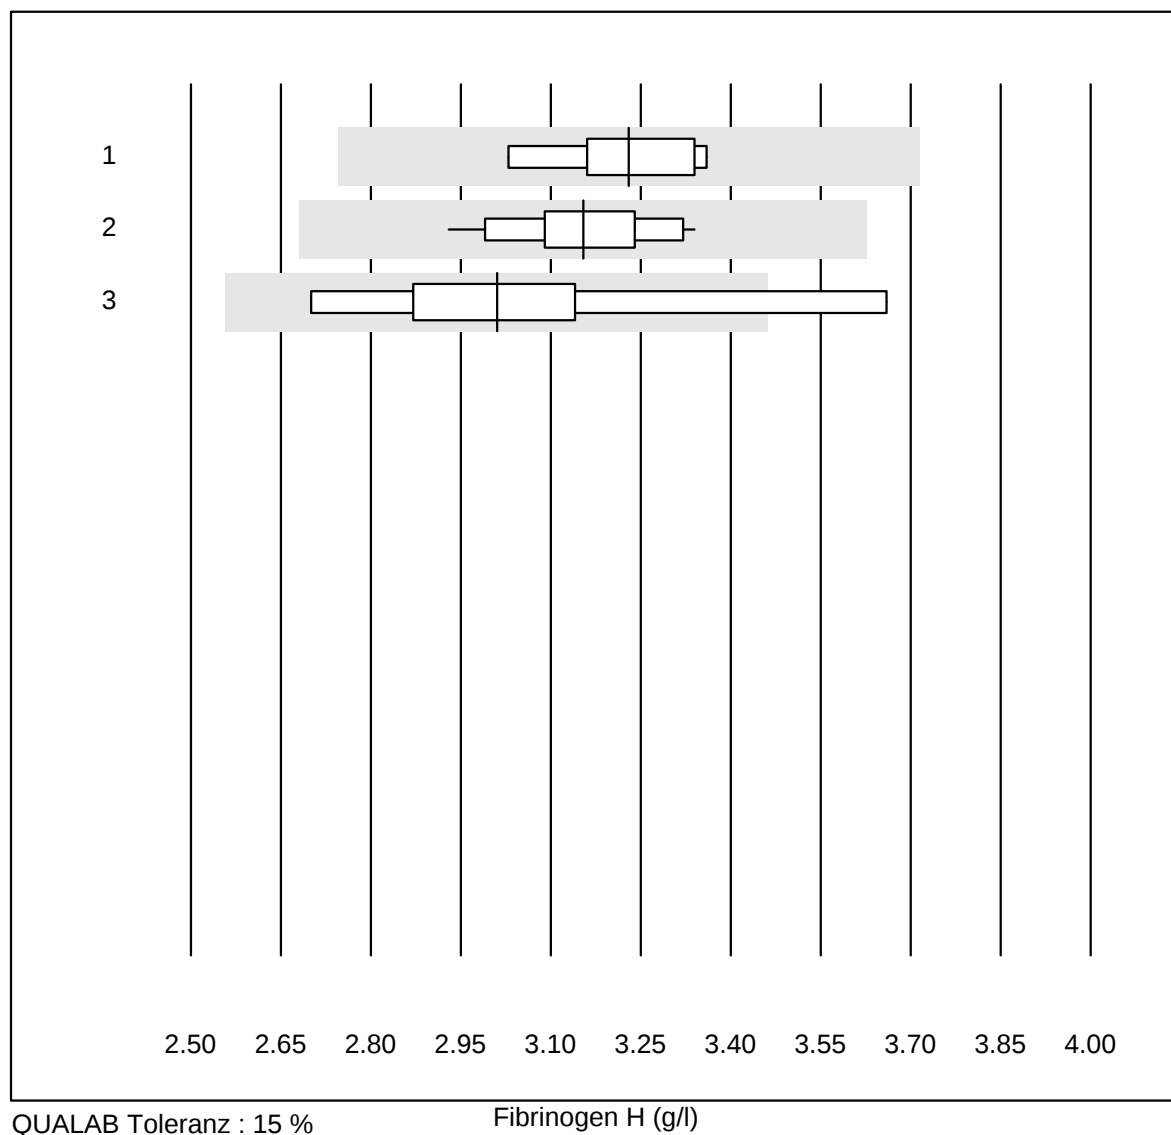

QUALAB Toleranz : 15 %

Fibrinogen H (g/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Siemens Thrombin	6	100.0	0.0	0.0	3.23	3.8	e
2	Stago/STA	12	100.0	0.0	0.0	3.15	3.9	e
3	Fibrinogen Q.F.A.	9	88.9	11.1	0.0	3.01	9.7	e*

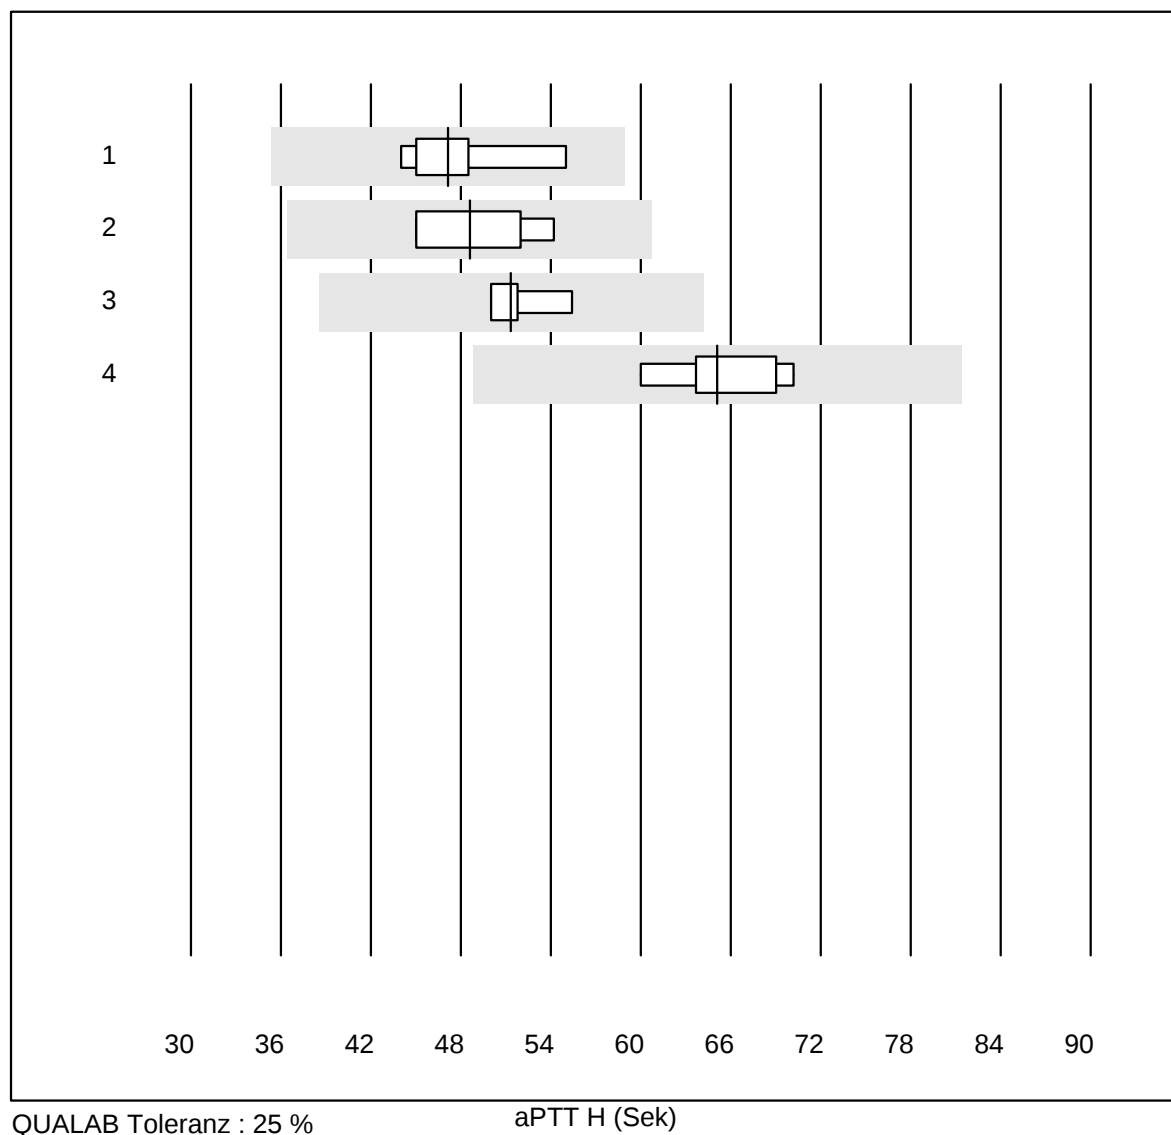
aPTT H

QUALAB Toleranz : 25 %

aPTT H (Sek)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Actin FS	6	100.0	0.0	0.0	47.2	8.2	e*
2	Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	48.6	9.6	e*
3	Stago/STA	8	100.0	0.0	0.0	51.4	3.5	e
4	aPTT-SP	9	100.0	0.0	0.0	65.1	5.4	e

D-Dimères

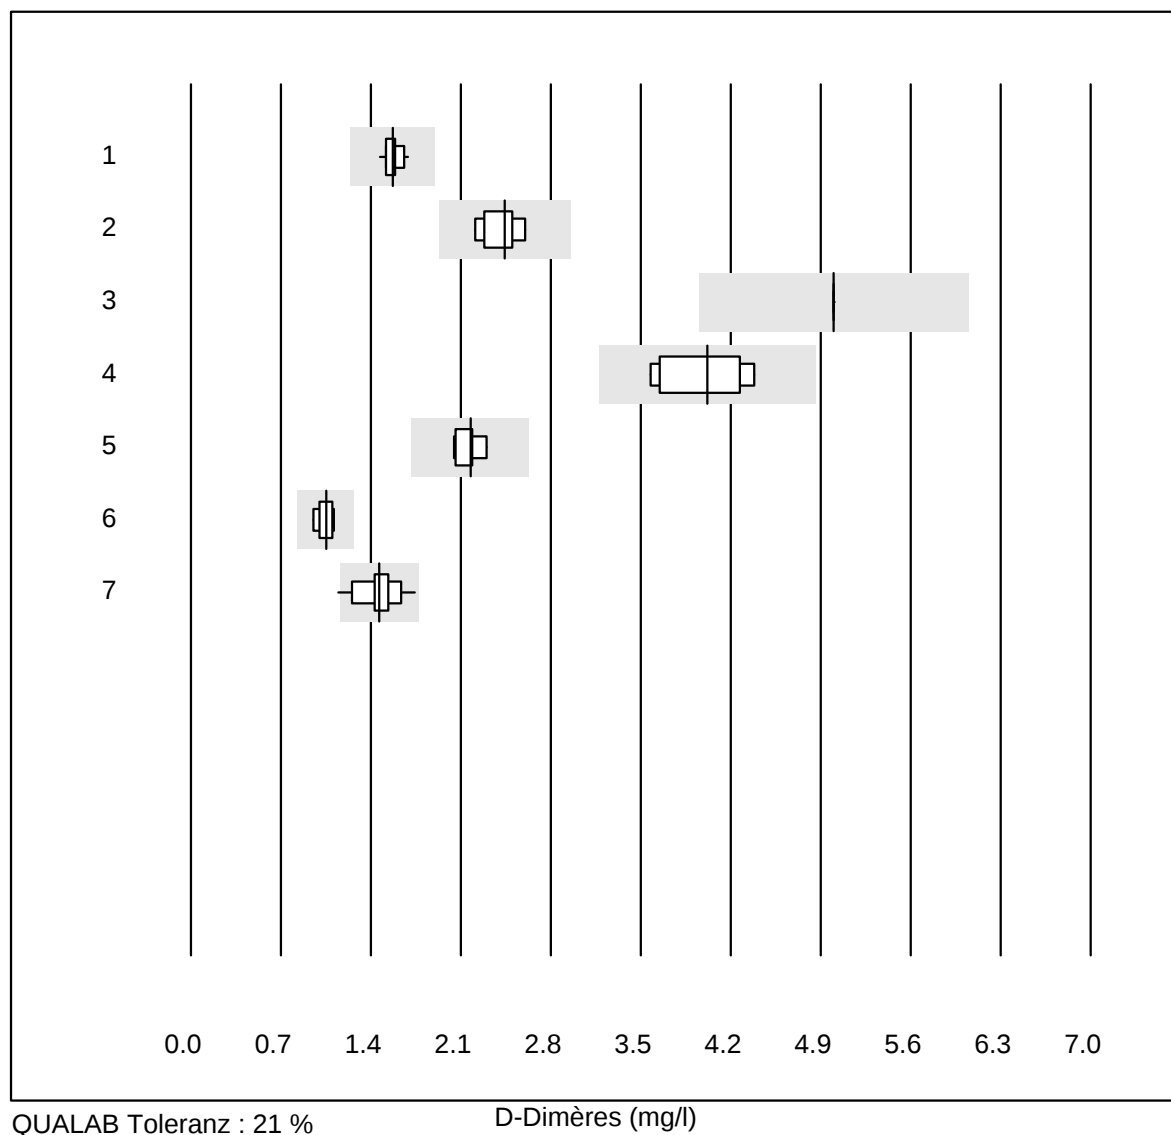


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	STA Liatest	12	91.7	0.0	8.3	1.57	4.0	e
2	Siemens Innovance	8	100.0	0.0	0.0	2.44	5.2	e
3	Eurolyser (Cutoff 0.	4	100.0	0.0	0.0	5.00	0.0	e
4	Eurolyser	6	100.0	0.0	0.0	4.02	8.2	e*
5	ACL	8	100.0	0.0	0.0	2.18	3.9	e
6	AQT 90 FLEX	9	100.0	0.0	0.0	1.05	5.6	e
7	VIDAS	18	94.4	5.6	0.0	1.47	8.9	e

CoaguChek APTT

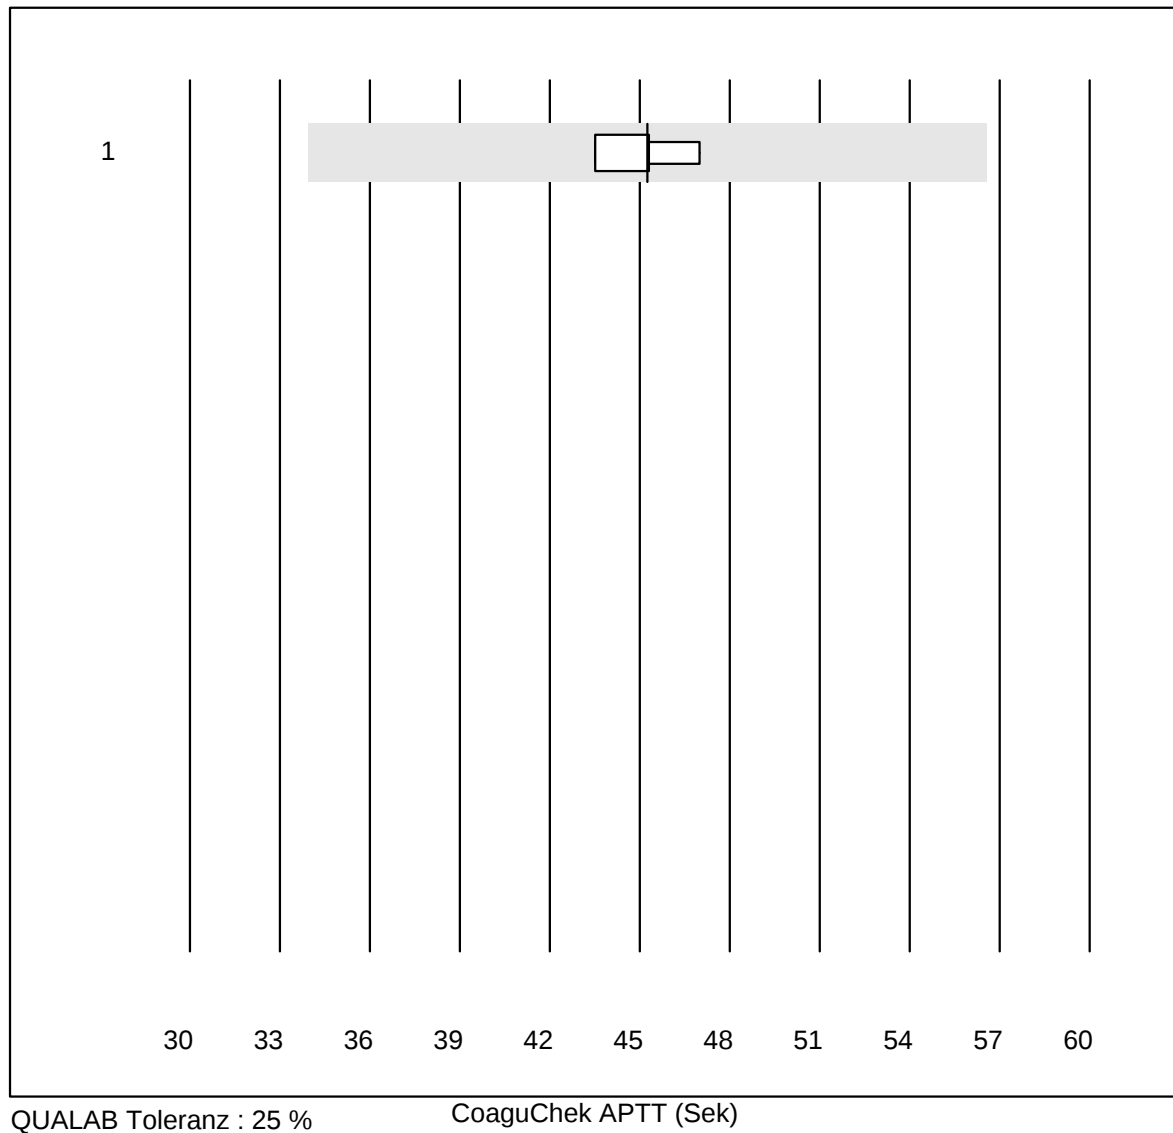


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	CoaguChek Pro II	6	66.7	0.0	33.3	45.3	3.2	e

INR CCXS

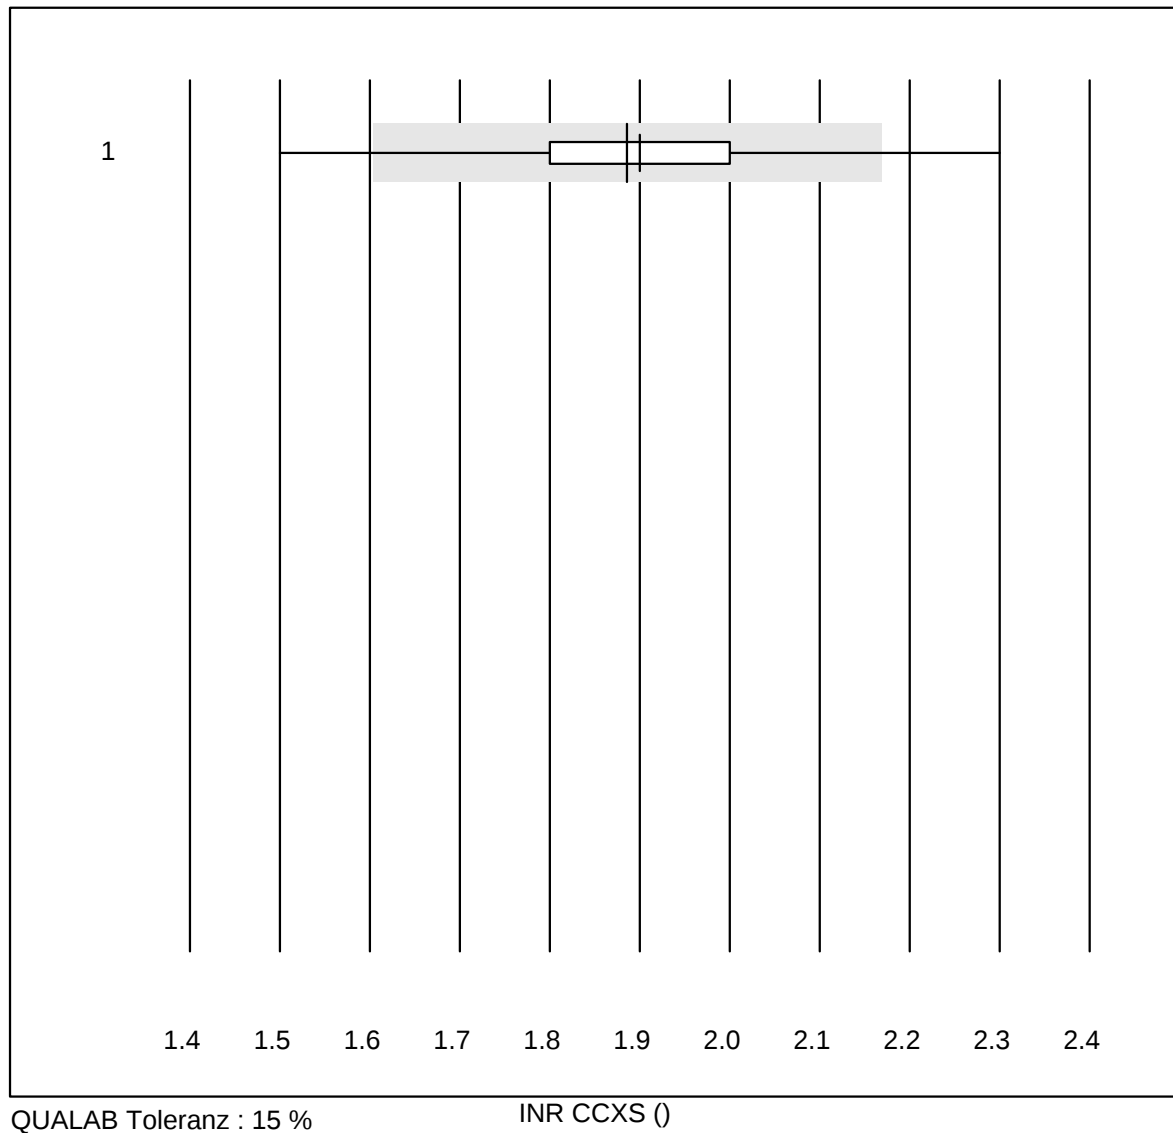

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	CoaguChek XS	1751	98.6	1.0	0.4	1.9	3.7	e

INR HC

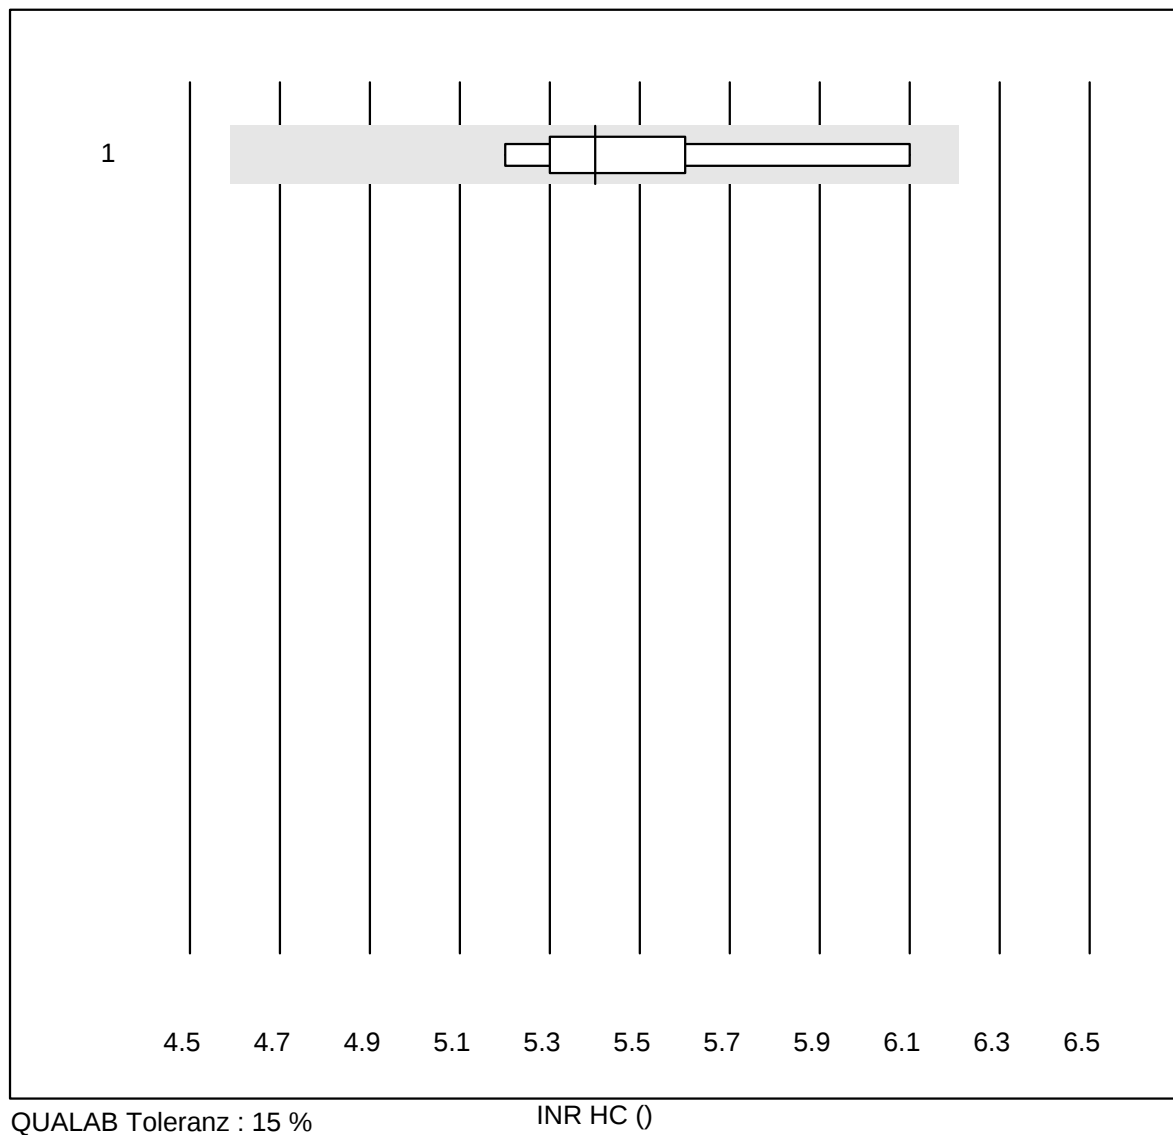


QUALAB Toleranz : 15 %

INR HC ()

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Hemochron j.	9	100.0	0.0	0.0	5.4	5.3	e

INR MI

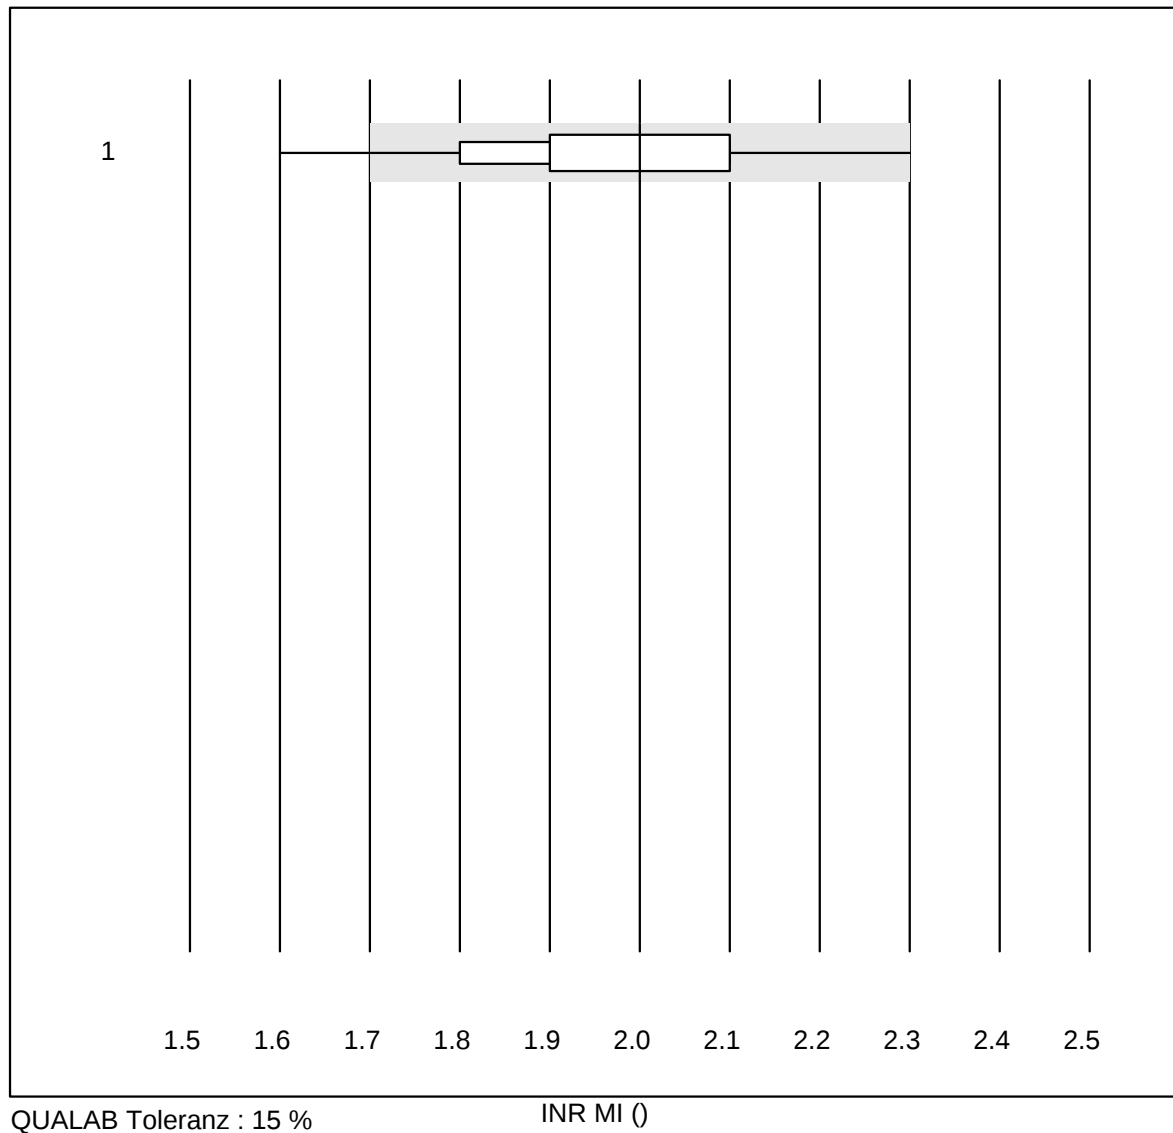


QUALAB Toleranz : 15 %

INR MI ()

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 MicroINR	125	83.2	7.2	9.6	2.0	6.8	e

INR Xprecia

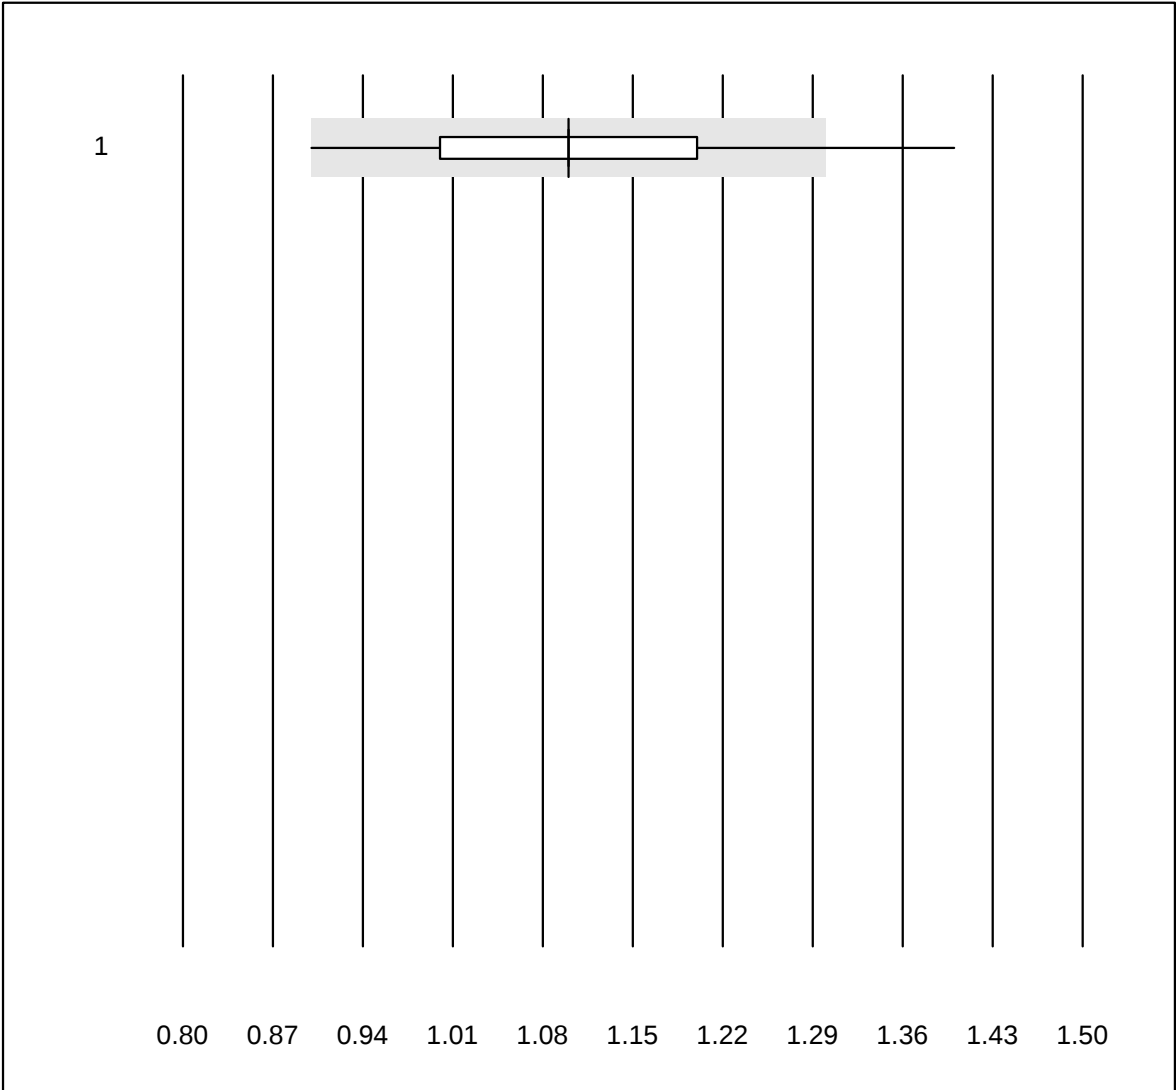


QUALAB Toleranz : 15 %
(< 1.3: +/- 0.2)

INR Xprecia ()


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Xprecia	62	93.5	6.5	0.0	1.1	6.5	e

INR Lumira Dx

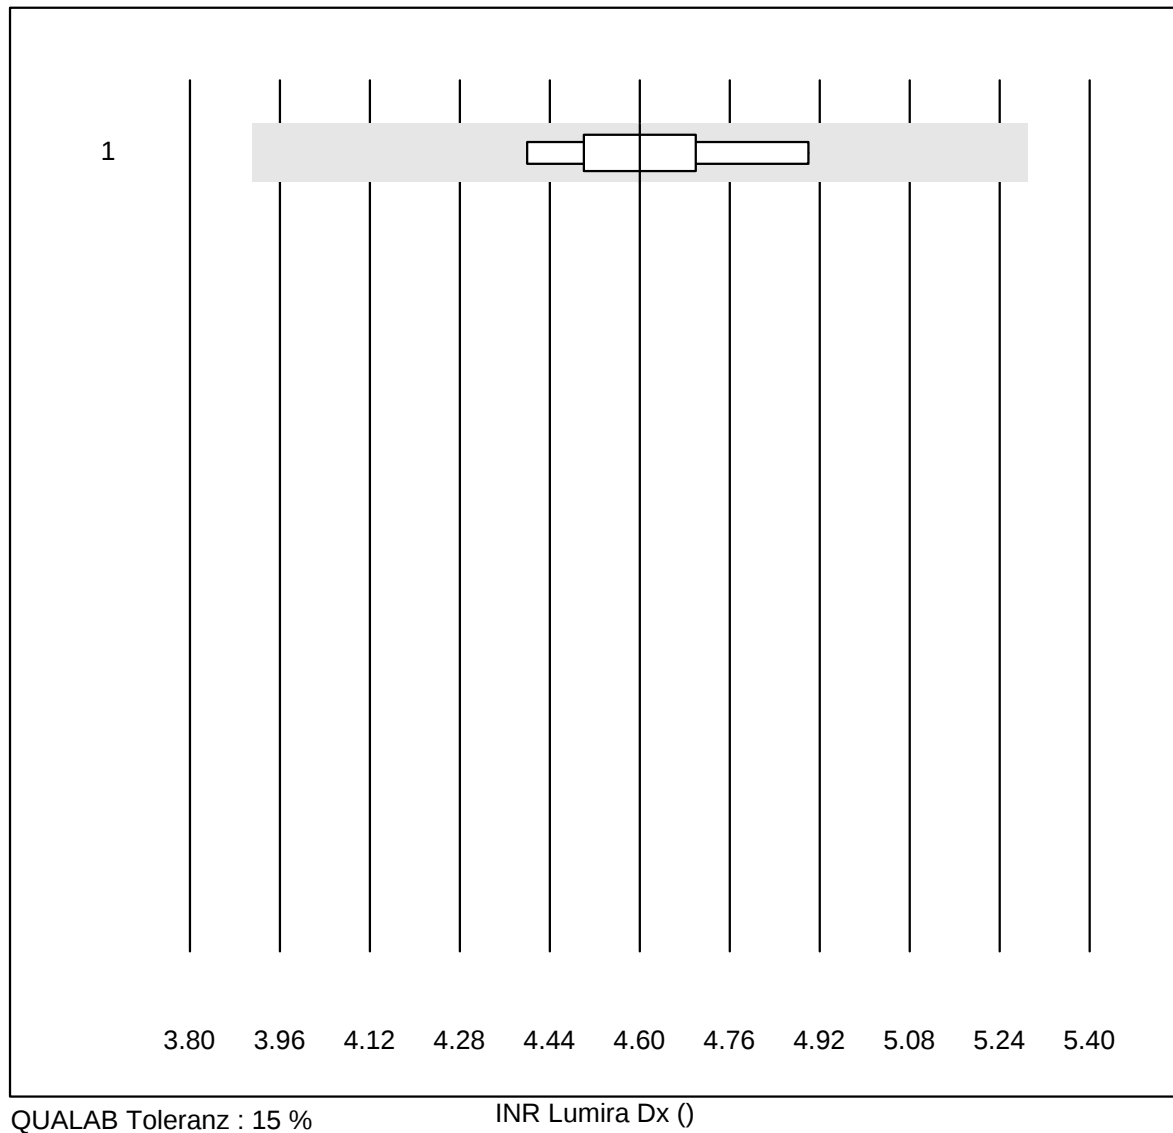


Nr. Methode		Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Lumira Dx	5	100.0	0.0	0.0	4.6	4.2	e*

Anti-FXa (LMW-Heparin)

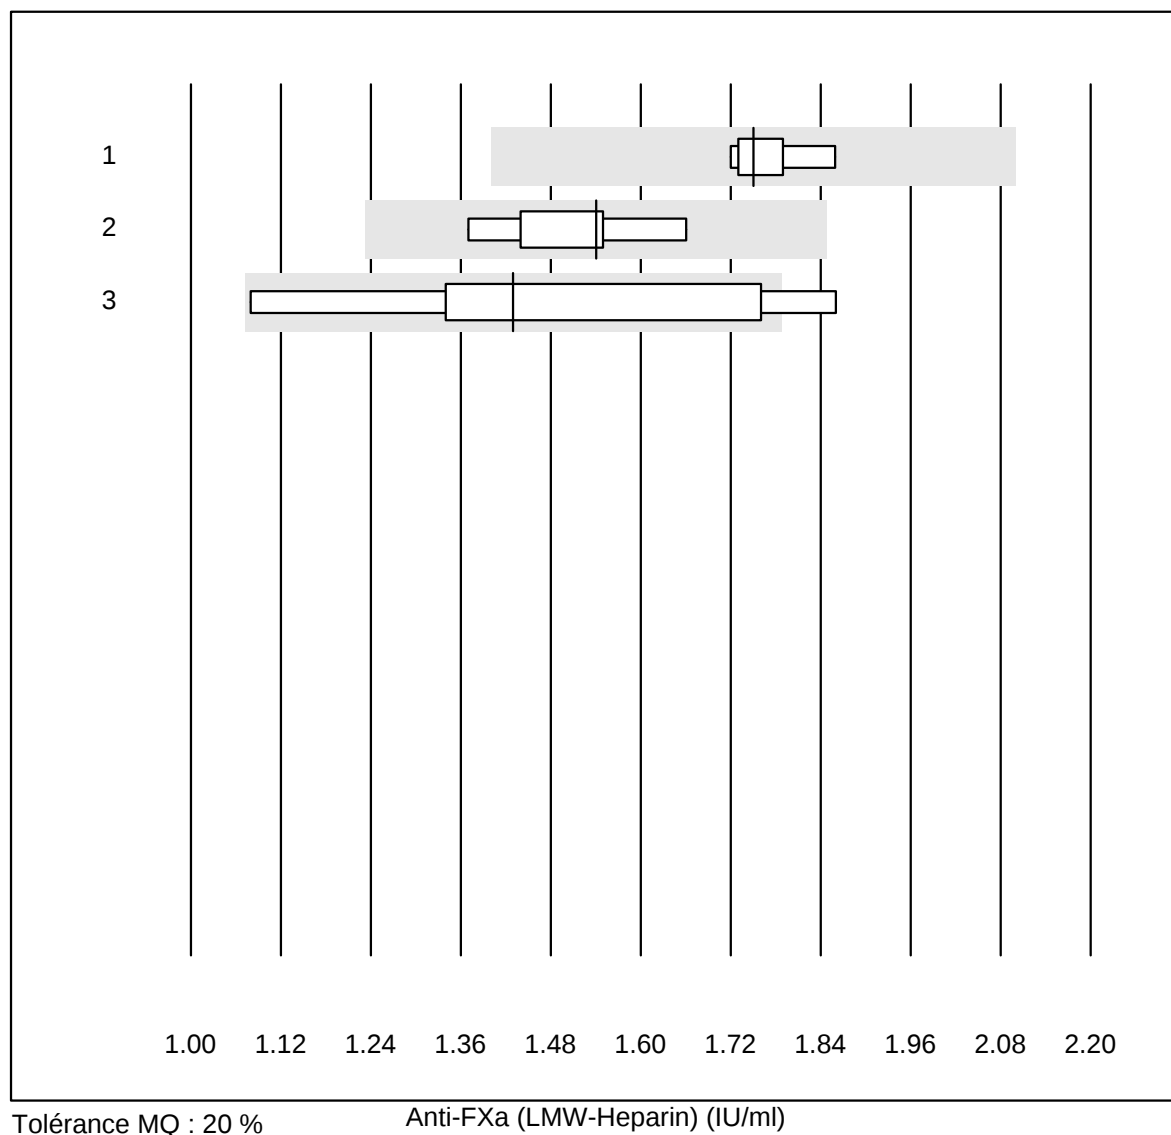

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	1.75	3.2	e
2 Stago/STA	8	100.0	0.0	0.0	1.54	5.8	e
3 ACL	9	77.8	22.2	0.0	1.43	20.1	a

Anti-FXa (Rivaroxaban)

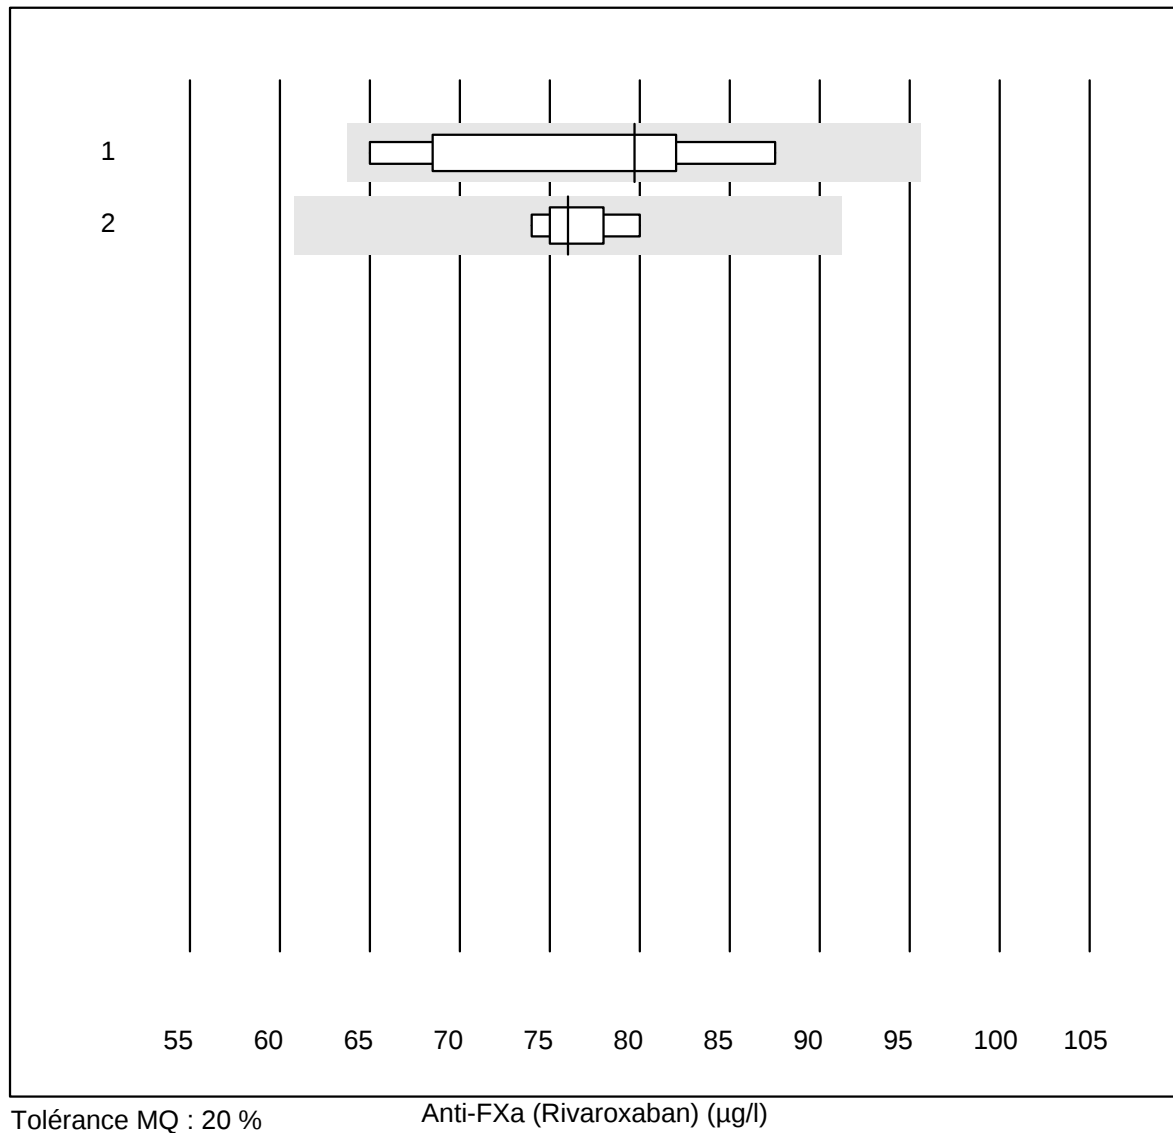


Tolérance MQ : 20 %

Anti-FXa (Rivaroxaban) (µg/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	79.69	10.3	e*
2	Stago/STA	5	100.0	0.0	0.0	76.00	3.1	e

Anti-FXa (Apixaban)

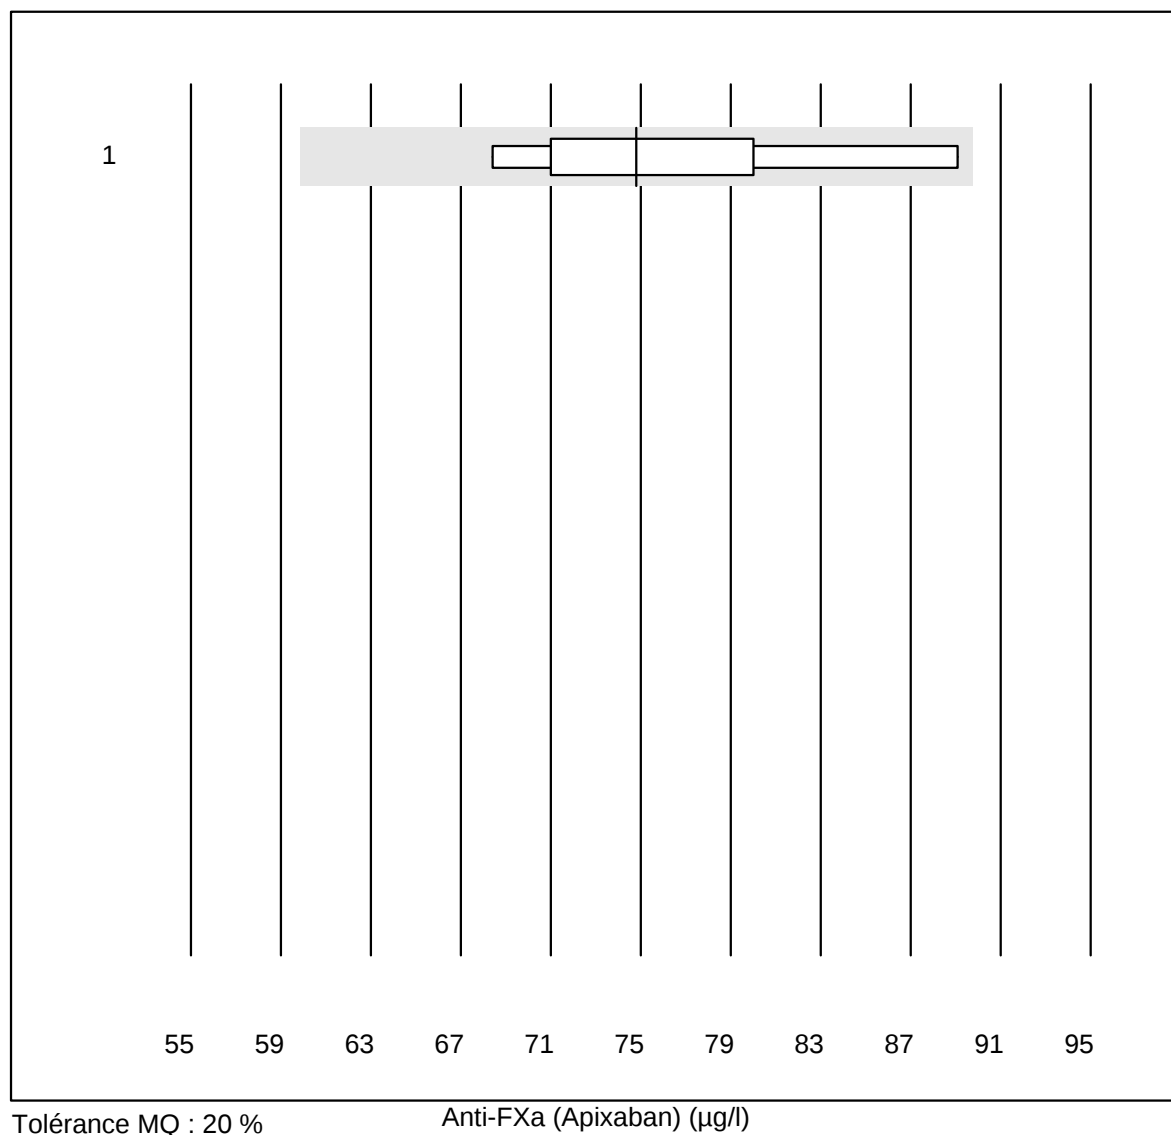


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	8	100.0	0.0	0.0	74.80	8.6	e*

Hémoglobine

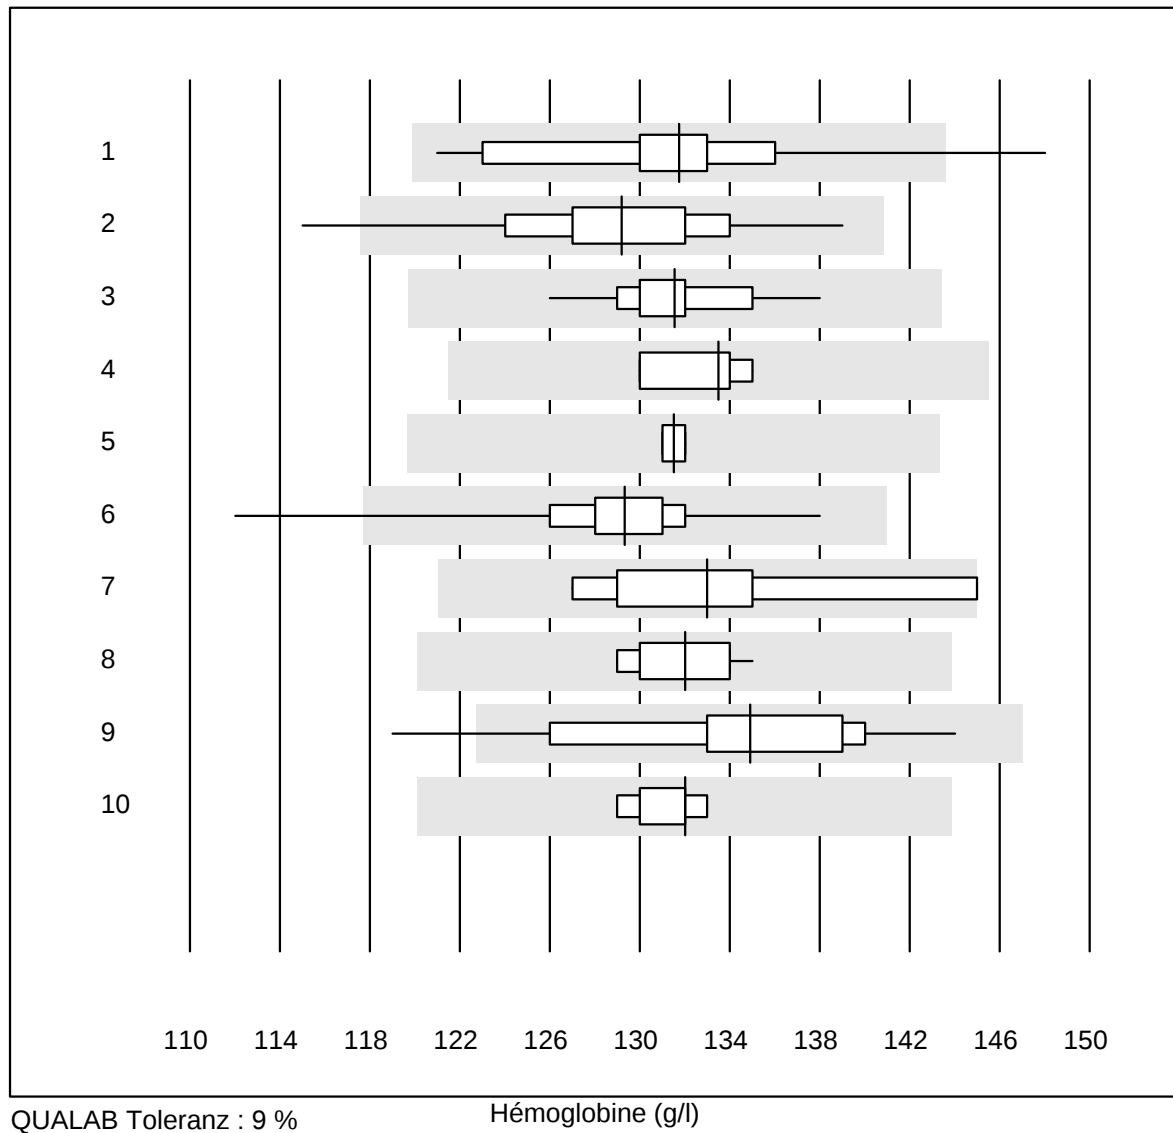


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Automate	17	94.1	5.9	0.0	131.7	4.3	e
2	Cyanmethémoglobine	27	92.6	3.7	3.7	129.2	3.5	e
3	Sysmex X	46	97.8	0.0	2.2	131.6	1.7	e
4	Advia 120	4	100.0	0.0	0.0	133.5	1.6	e
5	Yumizen/Pentra	4	100.0	0.0	0.0	131.5	0.4	e
6	Hemocue	402	95.3	0.7	4.0	129.3	2.5	e
7	Dr. Lange	7	71.4	14.3	14.3	133.0	4.7	e*
8	Hemocontrol	11	100.0	0.0	0.0	132.0	1.5	e
9	DiaSpect	17	70.6	5.9	23.5	134.9	4.8	e*
10	Sysmex	6	100.0	0.0	0.0	132.0	1.1	e

Hémoglobine

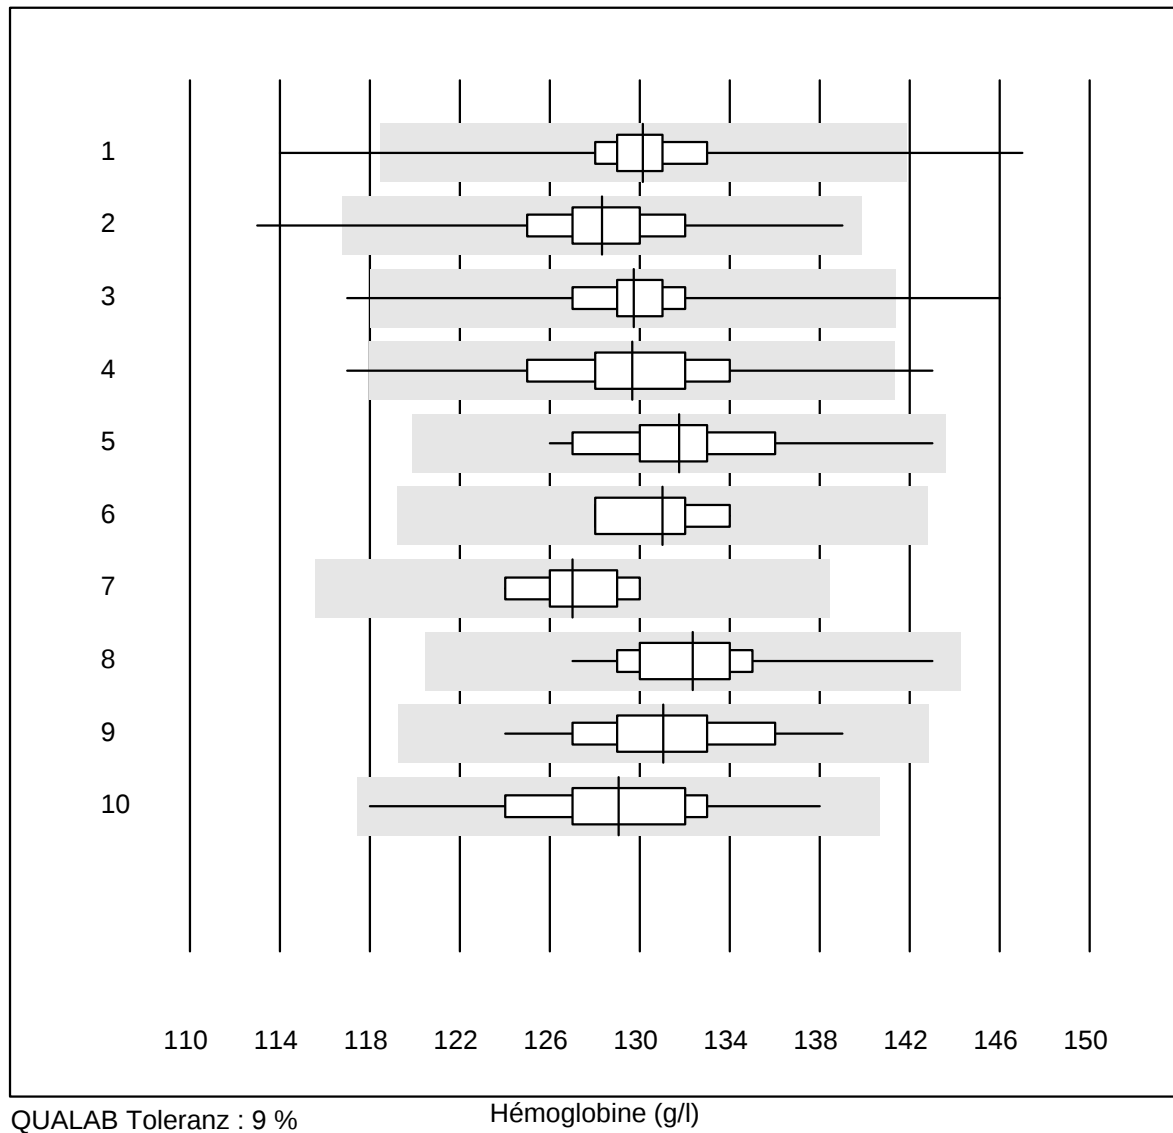


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex KX21	227	94.7	1.8	3.5	130.2	2.4	e
2	Sysmex PocH - 100i	200	96.0	0.5	3.5	128.3	2.5	e
3	Sysmex XP 300	567	96.8	1.1	2.1	129.7	1.9	e
4	Mythic	282	92.9	0.7	6.4	129.6	3.1	e
5	Swelab	35	100.0	0.0	0.0	131.7	2.7	e
6	Abacus Junior	5	80.0	0.0	20.0	131.0	1.9	e
7	Medonic	6	100.0	0.0	0.0	127.0	1.8	e
8	Celltac Alpha (Nihon	84	95.2	0.0	4.8	132.4	2.3	e
9	Samsung HC10	29	89.7	0.0	10.3	131.0	2.7	e
10	Micros 60	157	96.8	0.0	3.2	129.1	2.8	e

Hématocrite

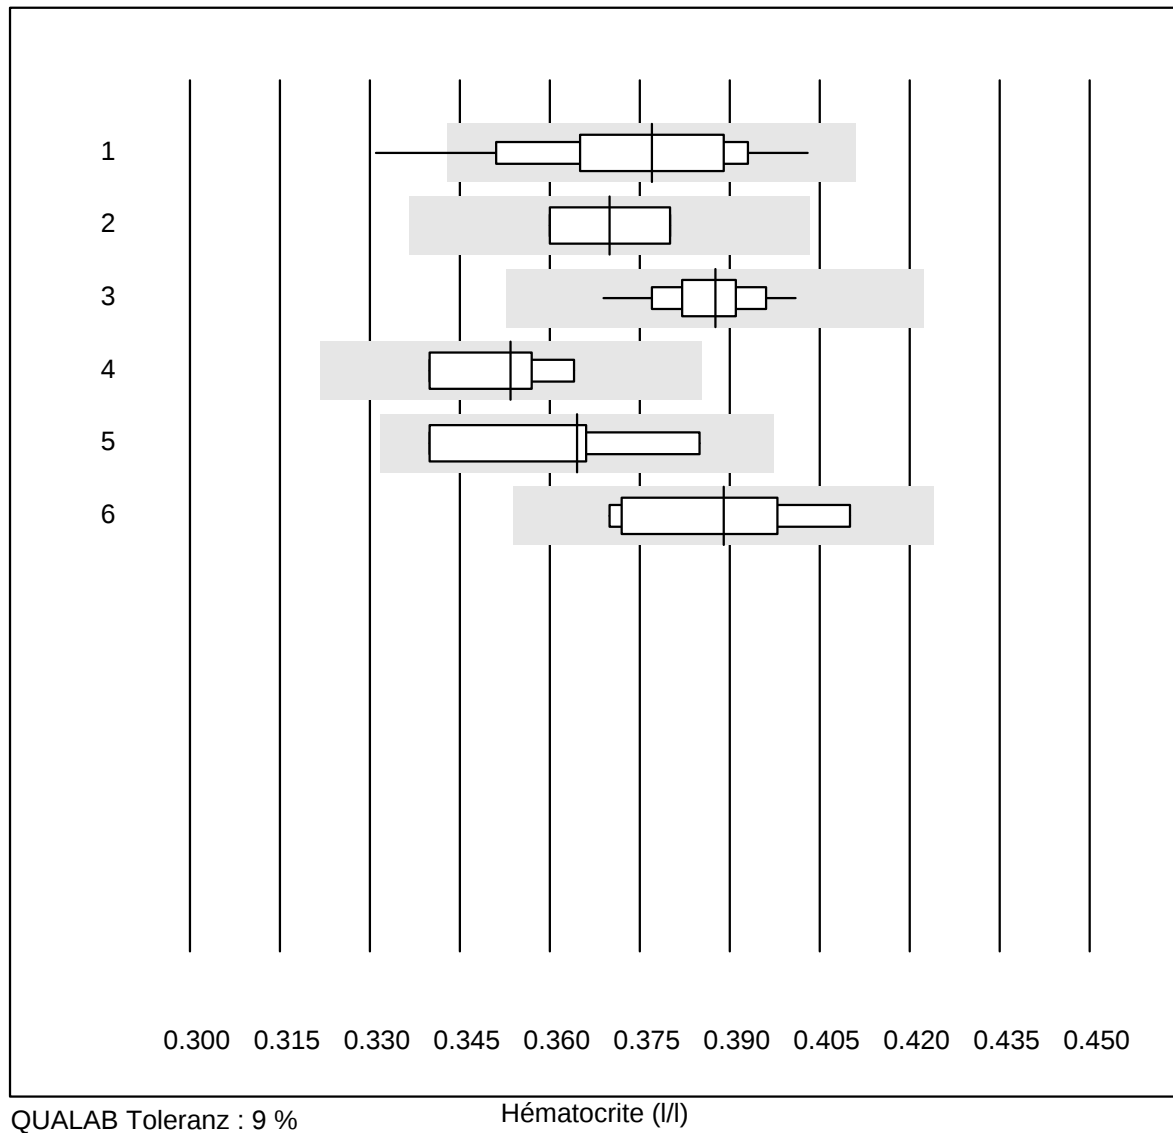


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Automate	14	92.9	7.1	0.0	0.38	5.1	e*
2	Centrifuge	5	100.0	0.0	0.0	0.37	2.7	e*
3	Sysmex X	46	97.8	0.0	2.2	0.39	1.9	e
4	Advia 120	4	100.0	0.0	0.0	0.35	2.9	e*
5	Yumizen/Pentra	4	100.0	0.0	0.0	0.36	5.1	e*
6	Sysmex	6	100.0	0.0	0.0	0.39	3.9	e*

Hématocrite

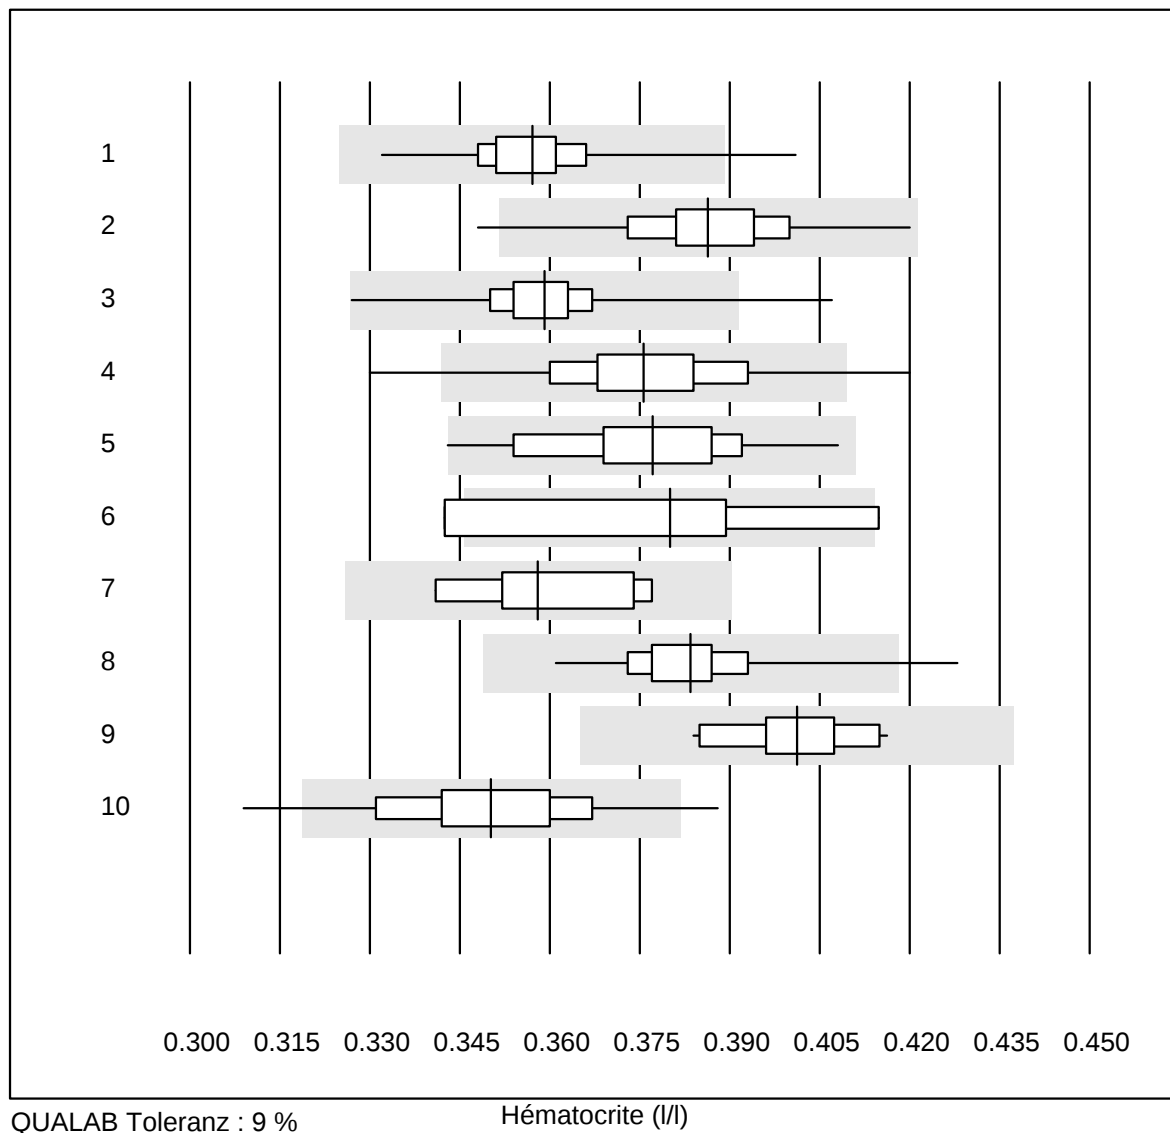


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex KX21	227	96.0	1.8	2.2	0.36	2.5	e
2	Sysmex PocH - 100i	201	95.5	1.5	3.0	0.39	3.1	e
3	Sysmex XP 300	567	97.7	0.5	1.8	0.36	2.2	e
4	Mythic	283	92.2	0.7	7.1	0.38	3.4	e
5	Swelab	35	97.1	2.9	0.0	0.38	3.7	e
6	Abacus Junior	5	40.0	40.0	20.0	0.38	7.9	e*
7	Medonic	6	100.0	0.0	0.0	0.36	3.8	e*
8	Celltac Alpha (Nihon	85	94.1	2.4	3.5	0.38	2.9	e
9	Samsung HC10	29	89.7	0.0	10.3	0.40	2.3	e
10	Micros 60	157	92.3	4.5	3.2	0.35	4.0	e

Erythrocytes

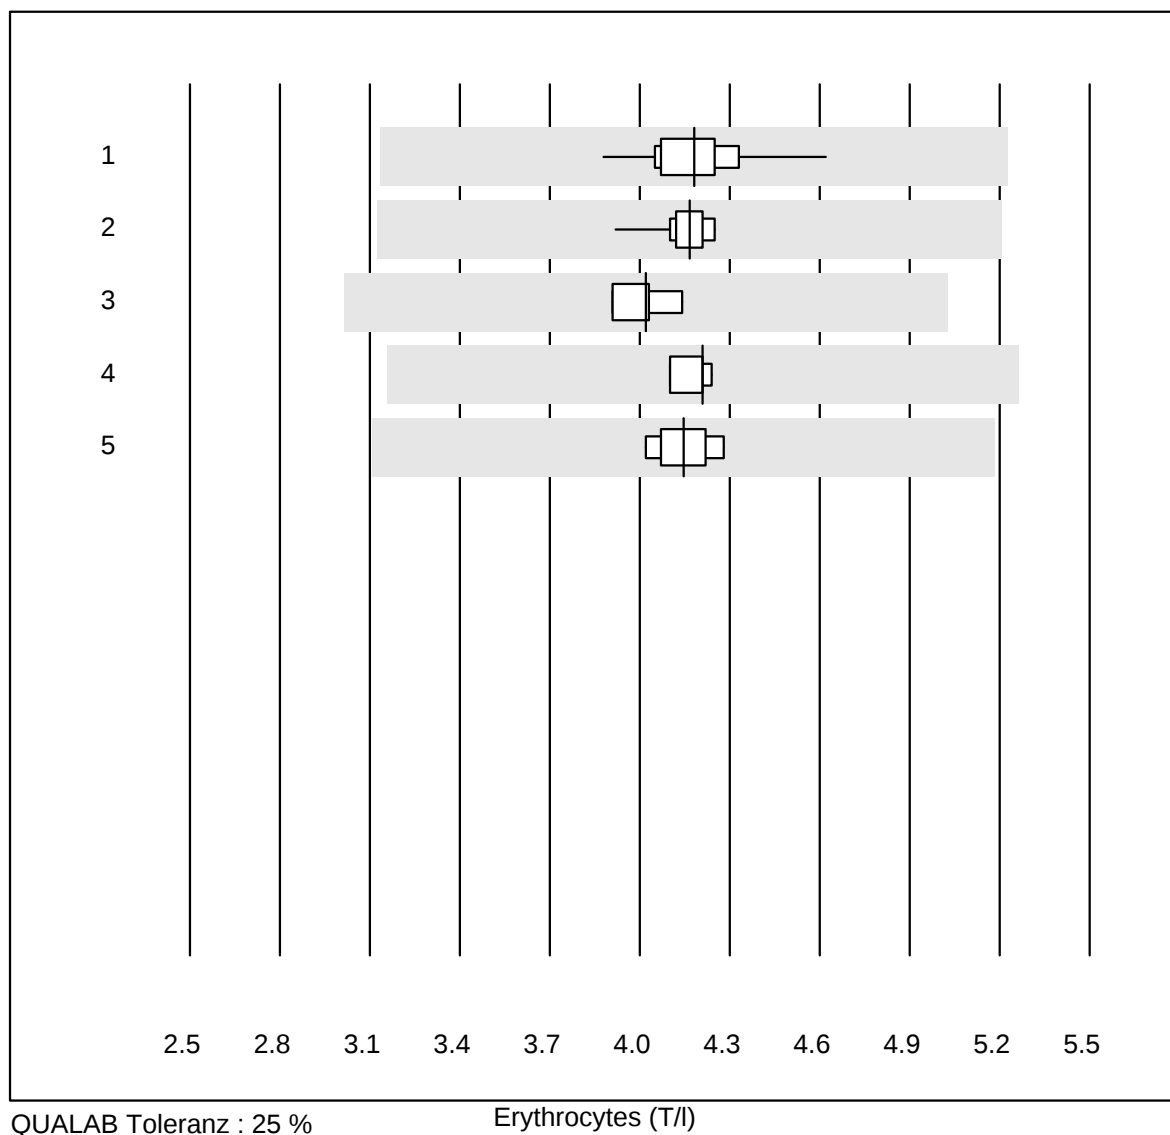


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Automate	14	100.0	0.0	0.0	4.18	4.1	e
2	Sysmex X	46	97.8	0.0	2.2	4.17	1.6	e
3	Advia 120	4	100.0	0.0	0.0	4.02	2.3	e
4	Yumizen/Pentra	4	100.0	0.0	0.0	4.21	1.5	e
5	Sysmex	6	100.0	0.0	0.0	4.15	2.4	e

Erythrocytes

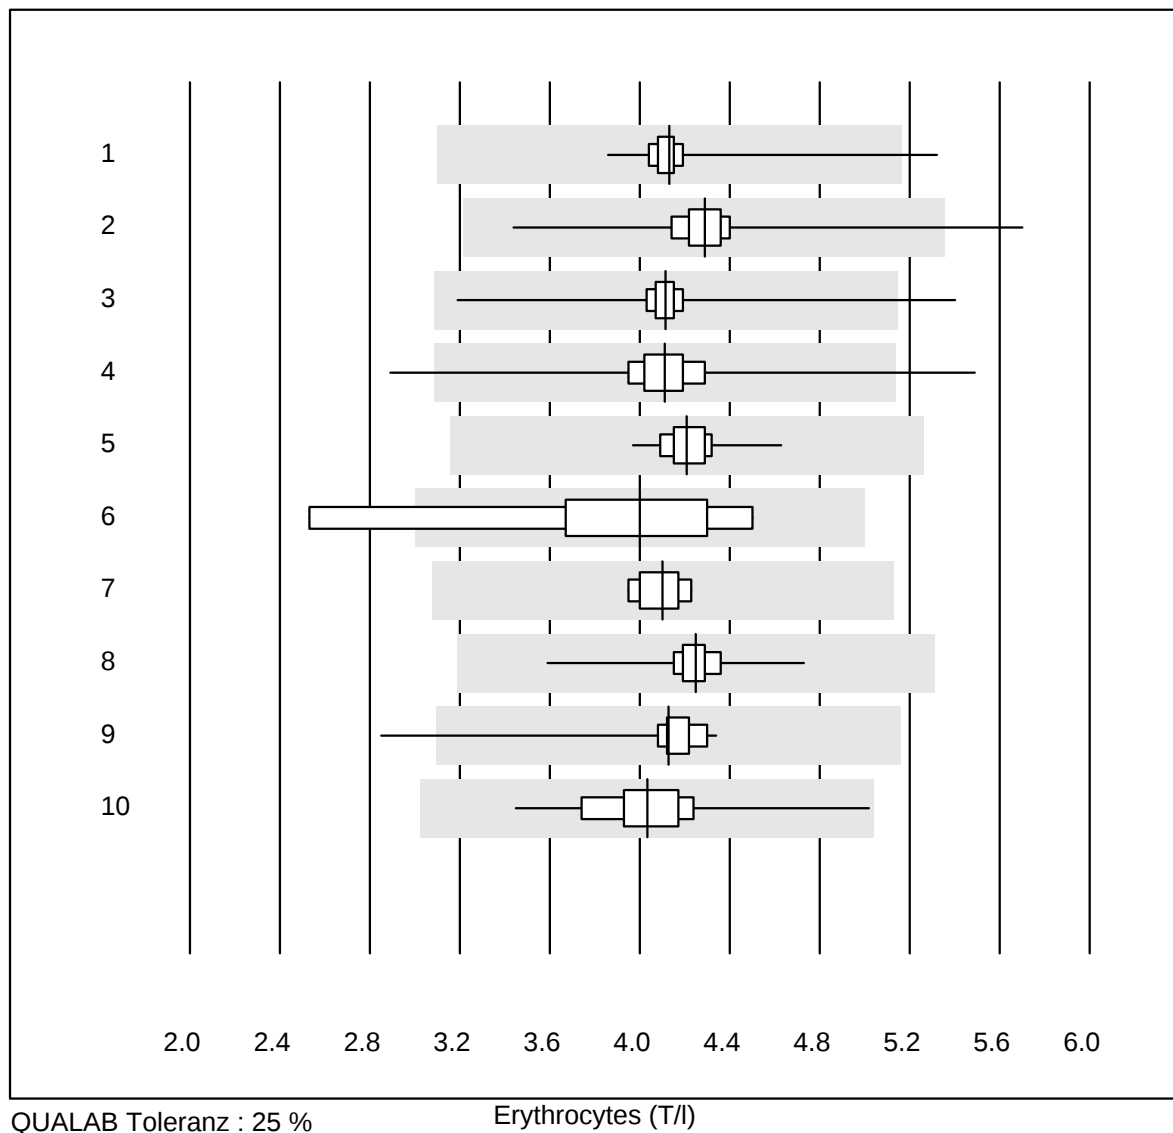

Leucocytes

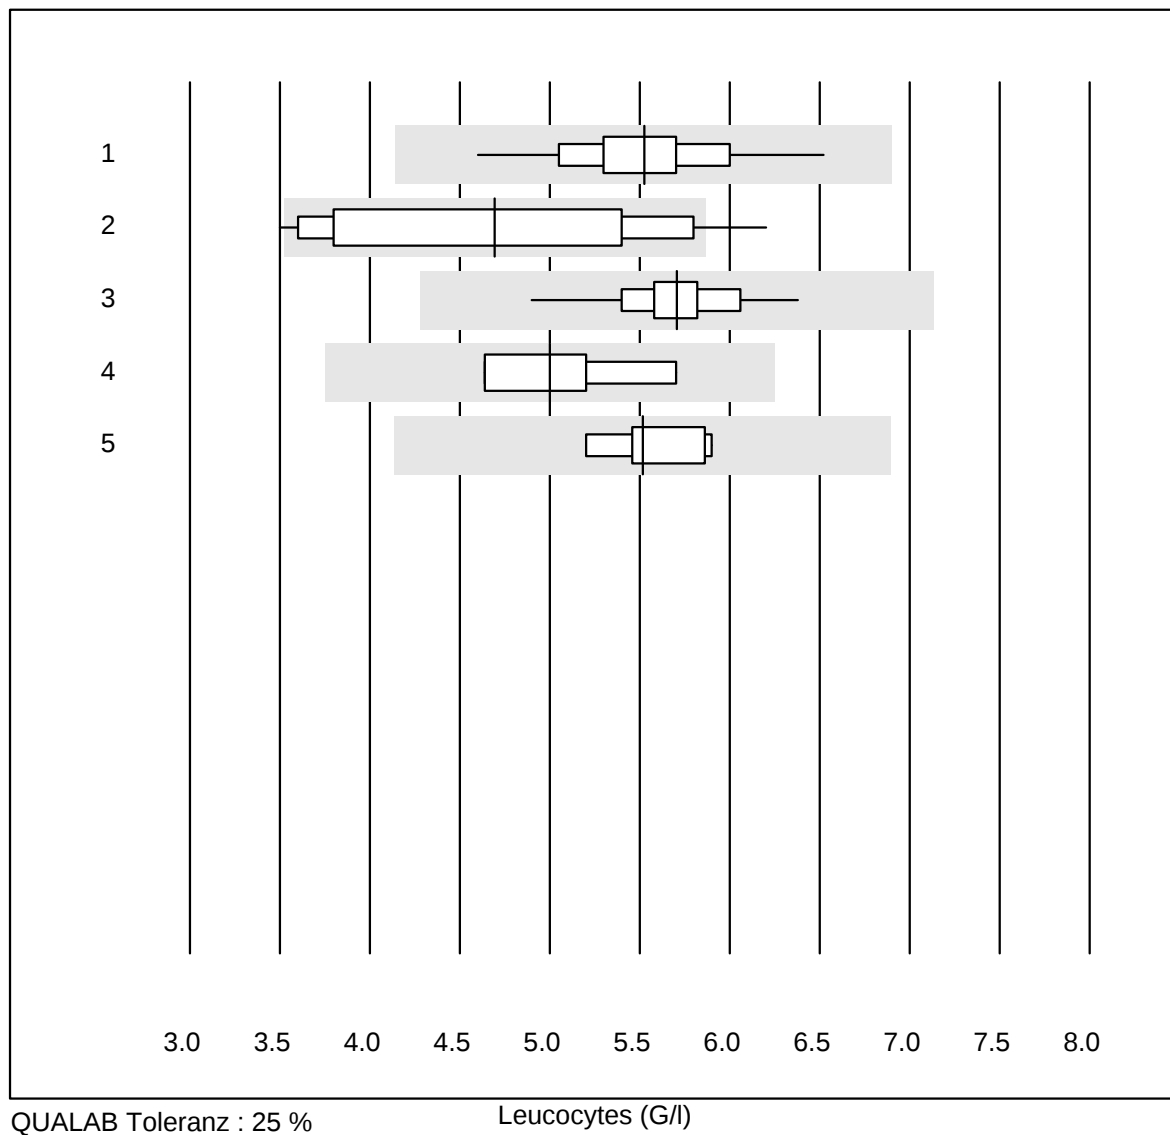


QUALAB Toleranz : 25 %

Leucocytes (G/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Automate	12	100.0	0.0	0.0	5.52	8.7	e
2	Microscopie	19	73.7	10.5	15.8	4.69	19.3	e*
3	Sysmex X	46	100.0	0.0	0.0	5.71	4.8	e
4	Advia 120 (Perox)	4	100.0	0.0	0.0	5.00	9.3	e*
5	Sysmex	6	100.0	0.0	0.0	5.52	4.7	e

Leucocytes

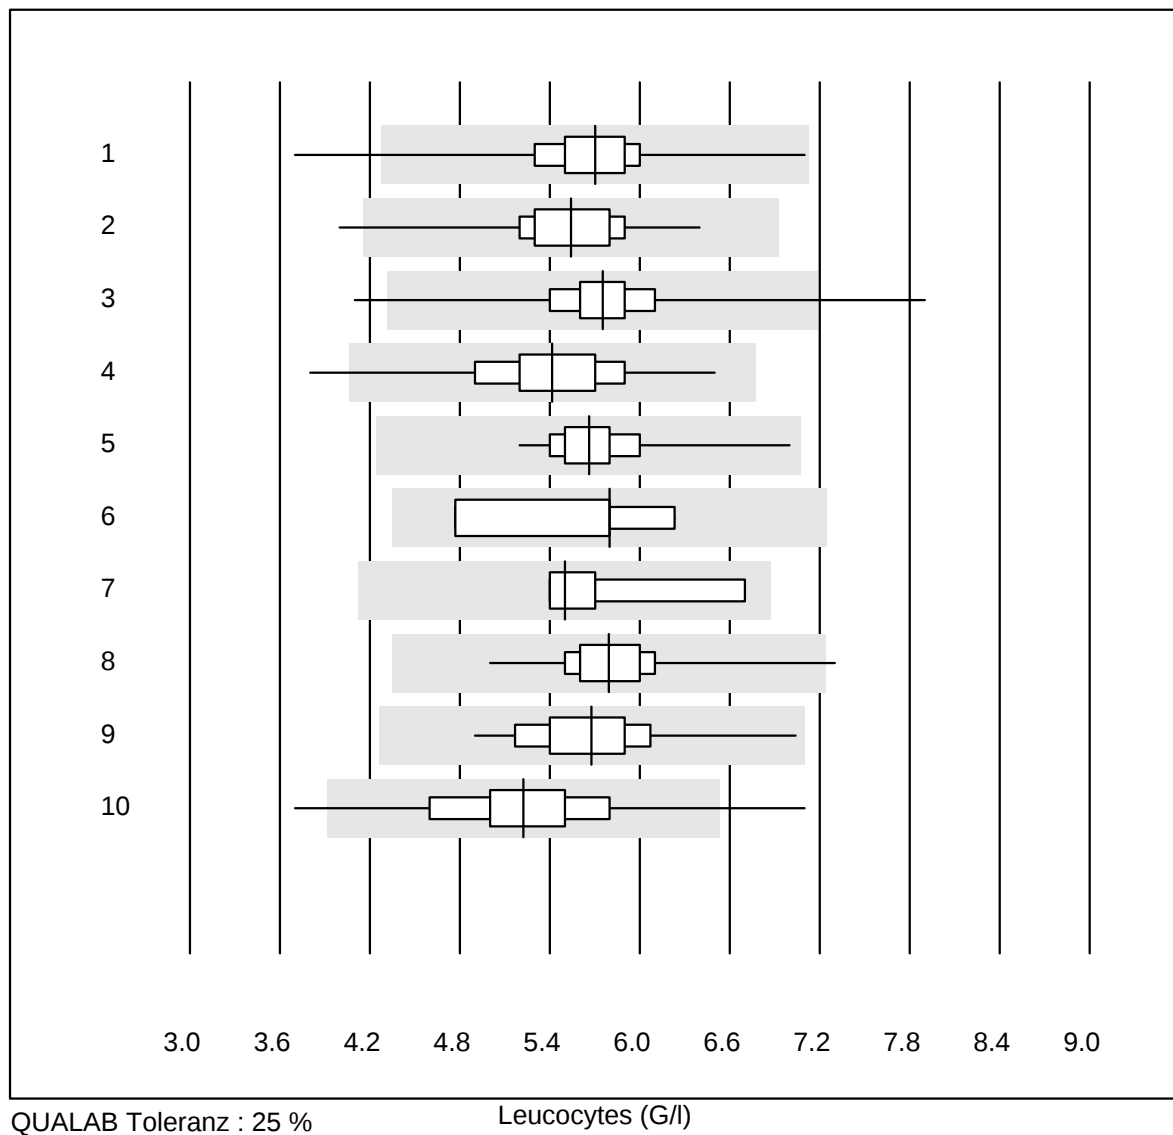


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex KX21	227	98.7	0.4	0.9	5.70	6.6	e
2	Sysmex PocH - 100i	200	98.0	0.5	1.5	5.54	6.1	e
3	Sysmex XP 300	568	99.3	0.7	0.0	5.75	6.1	e
4	Mythic	282	96.8	1.1	2.1	5.42	7.8	e
5	Swelab	35	100.0	0.0	0.0	5.66	5.9	e
6	Abacus Junior	5	80.0	0.0	20.0	5.80	10.9	e*
7	Medonic	6	100.0	0.0	0.0	5.50	8.8	e*
8	Celltac Alpha (Nihon	85	97.6	1.2	1.2	5.79	5.3	e
9	Samsung HC10	29	93.1	0.0	6.9	5.68	7.6	e
10	Micros 60	157	96.8	1.9	1.3	5.23	9.0	e

Thrombocytes

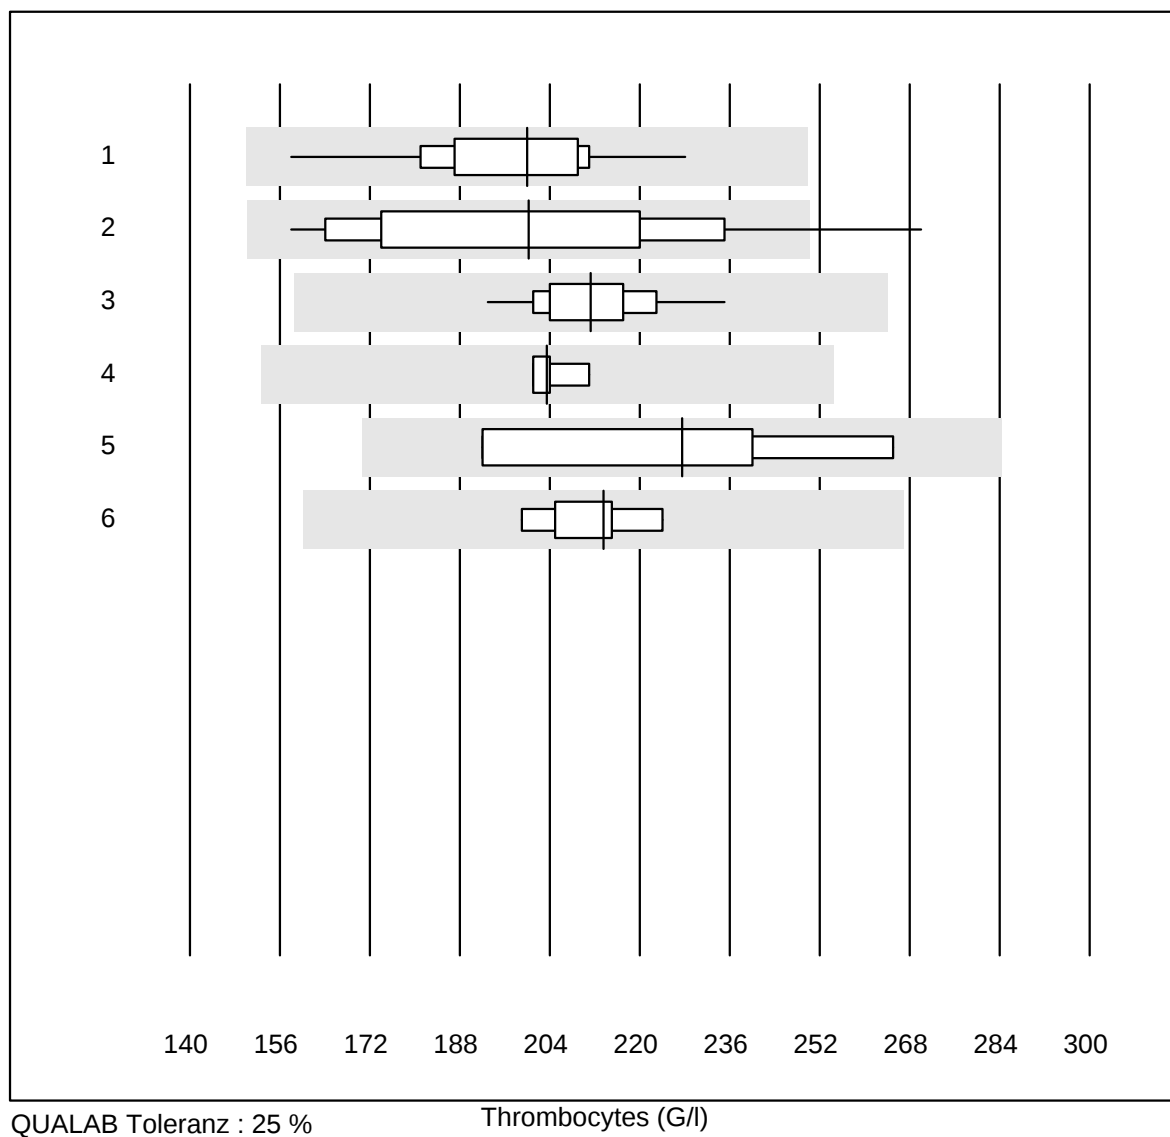


Thrombocytes

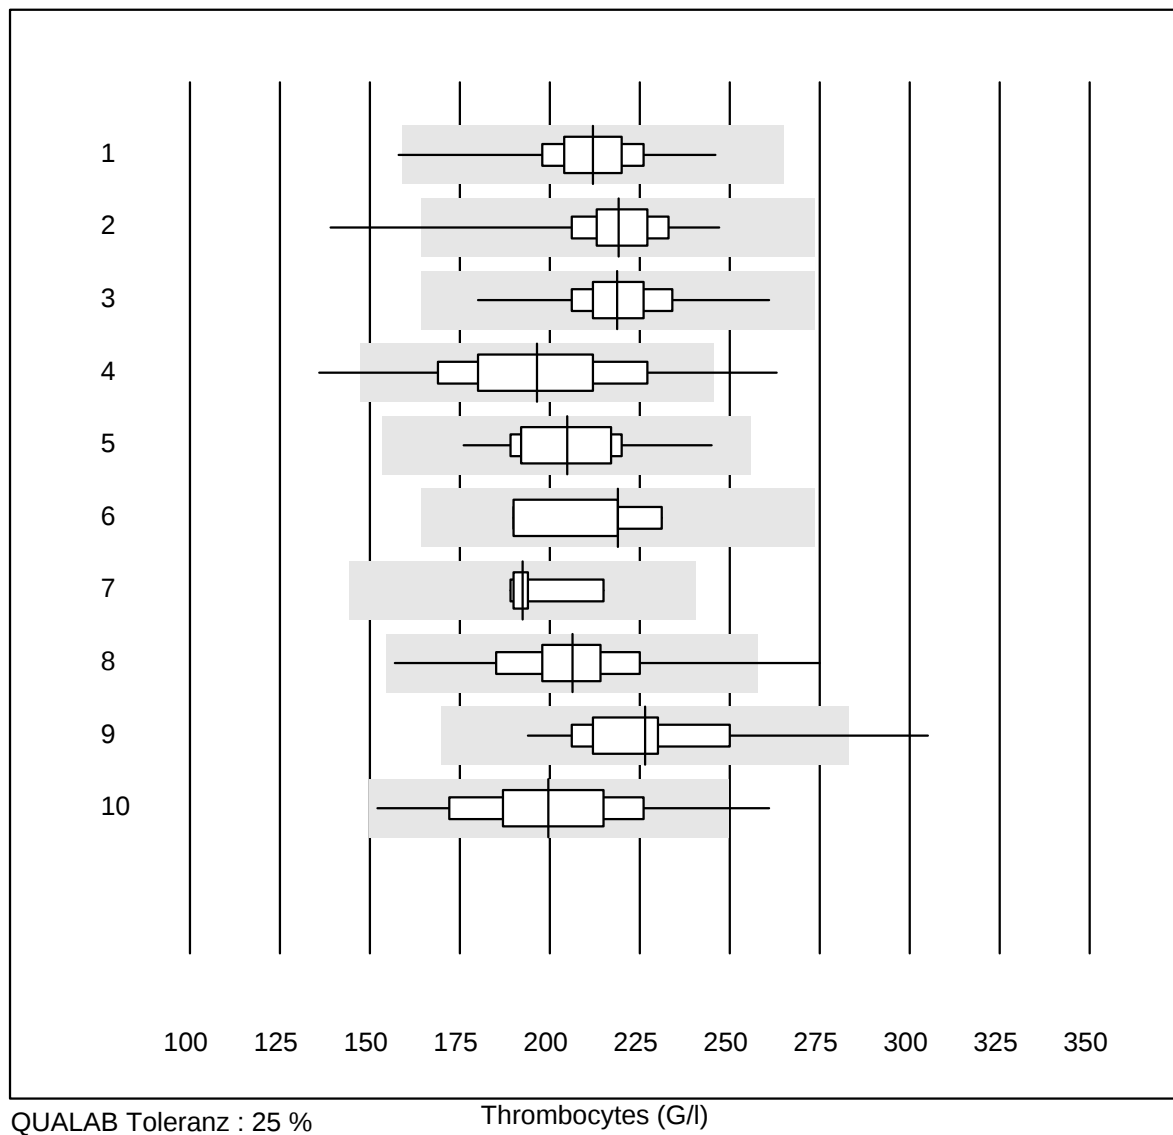

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex KX21	227	98.3	0.4	1.3	211.9	5.6	e
2	Sysmex PocH - 100i	200	99.0	1.0	0.0	219.0	6.0	e
3	Sysmex XP 300	567	99.8	0.0	0.2	218.8	5.1	e
4	Mythic	283	96.8	1.8	1.4	196.4	11.4	e
5	Swelab	35	100.0	0.0	0.0	204.8	7.2	e
6	Abacus Junior	5	80.0	0.0	20.0	219.0	8.3	e*
7	Medonic	6	100.0	0.0	0.0	192.5	5.0	e
8	Celltac Alpha (Nihon	85	98.8	1.2	0.0	206.2	8.1	e
9	Samsung HC10	29	93.1	6.9	0.0	226.4	11.0	e
10	Micros 60	156	96.1	2.6	1.3	199.6	10.8	e

Hémoglobine H2

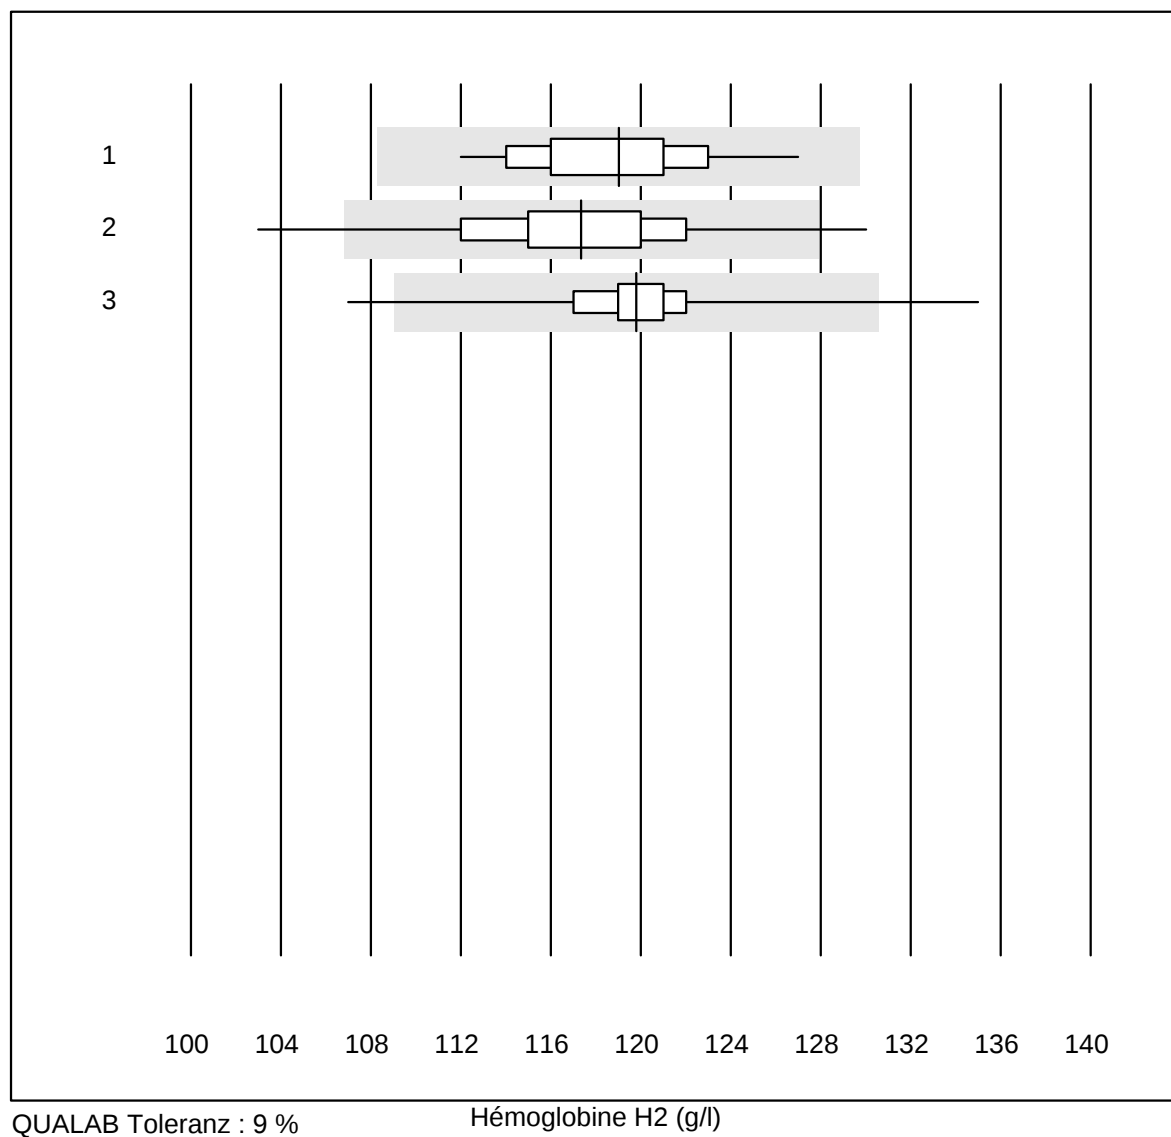


QUALAB Toleranz : 9 %

Hémoglobine H2 (g/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Z3	58	98.3	0.0	1.7	119.0	2.9	e
2	Abx Micros	137	91.3	3.6	5.1	117.3	3.8	e
3	Microsemi	765	94.5	0.5	5.0	119.8	2.0	e

Hématocrite H2

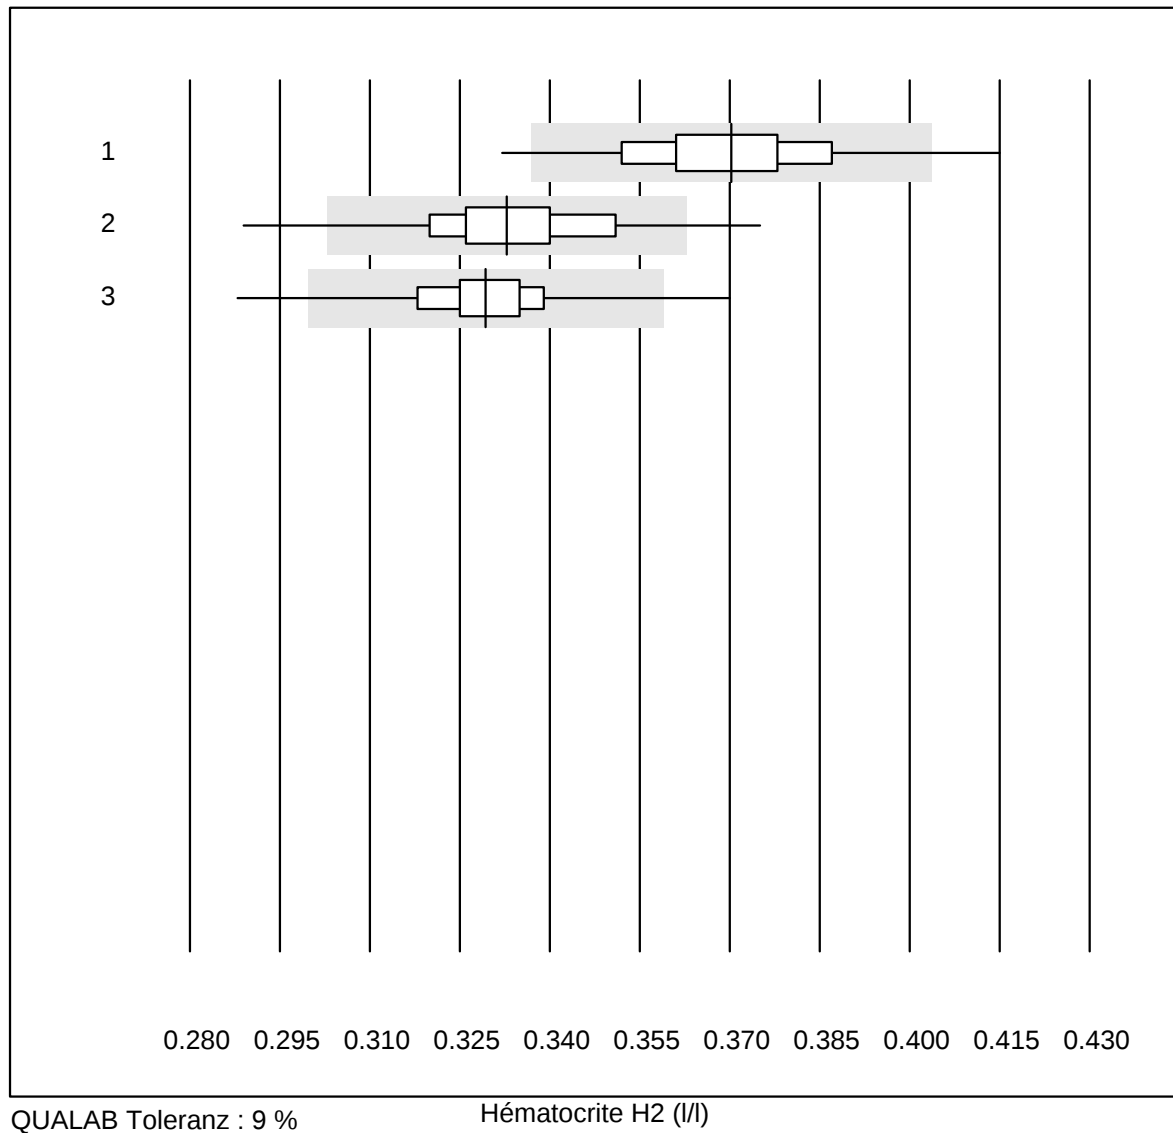

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Z3	58	93.1	5.2	1.7	0.37	4.1	e
2	Abx Micros	137	89.8	5.1	5.1	0.33	3.9	e
3	Microsemi	764	93.7	0.9	5.4	0.33	2.7	e

Leucocytes H2

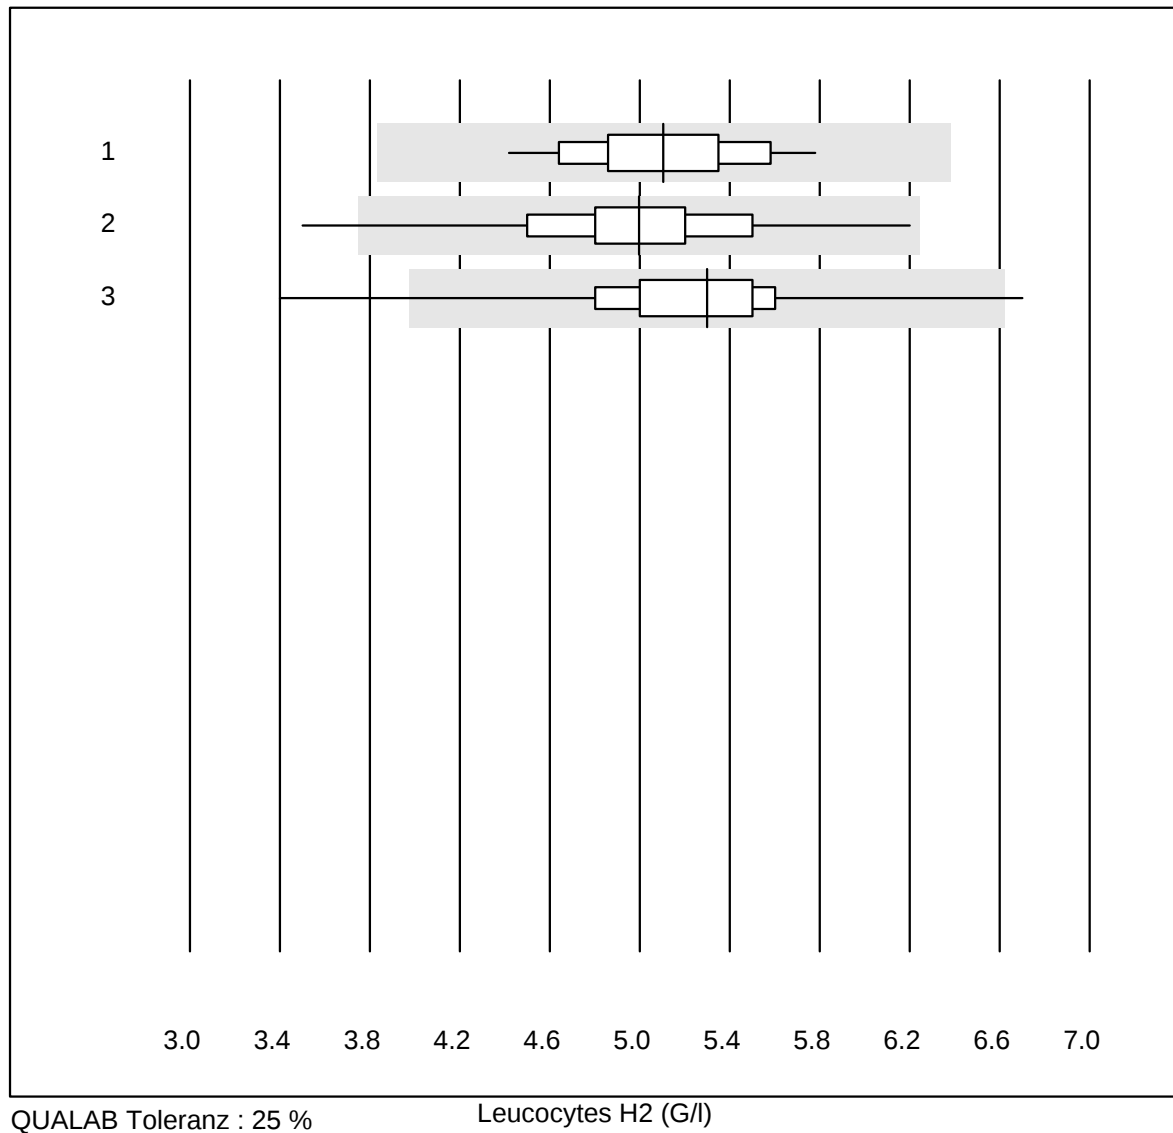


QUALAB Toleranz : 25 %

Leucocytes H2 (G/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Z3	58	100.0	0.0	0.0	5.11	6.6	e
2	Abx Micros	137	96.3	1.5	2.2	5.00	8.7	e
3	Microsemi	765	98.0	0.8	1.2	5.30	7.1	e

Thrombocytes H2

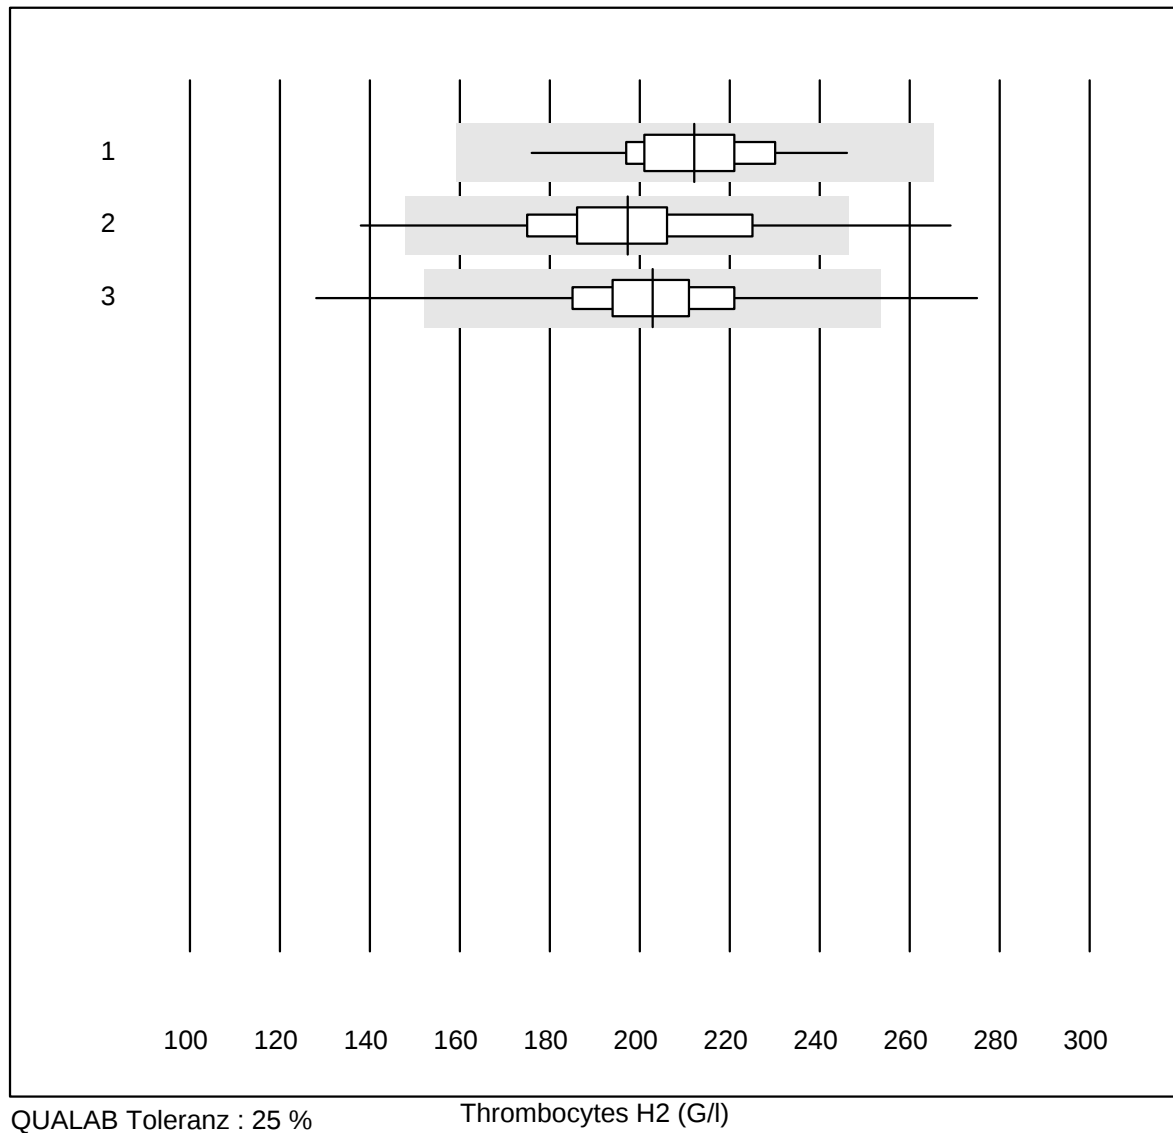


QUALAB Toleranz : 25 %

Thrombocytes H2 (G/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Z3	58	100.0	0.0	0.0	212.2	6.8	e
2	Abx Micros	137	87.6	4.4	8.0	197.3	10.7	e
3	Microsemi	765	95.3	2.0	2.7	202.8	8.1	e

Erythrocytes H2

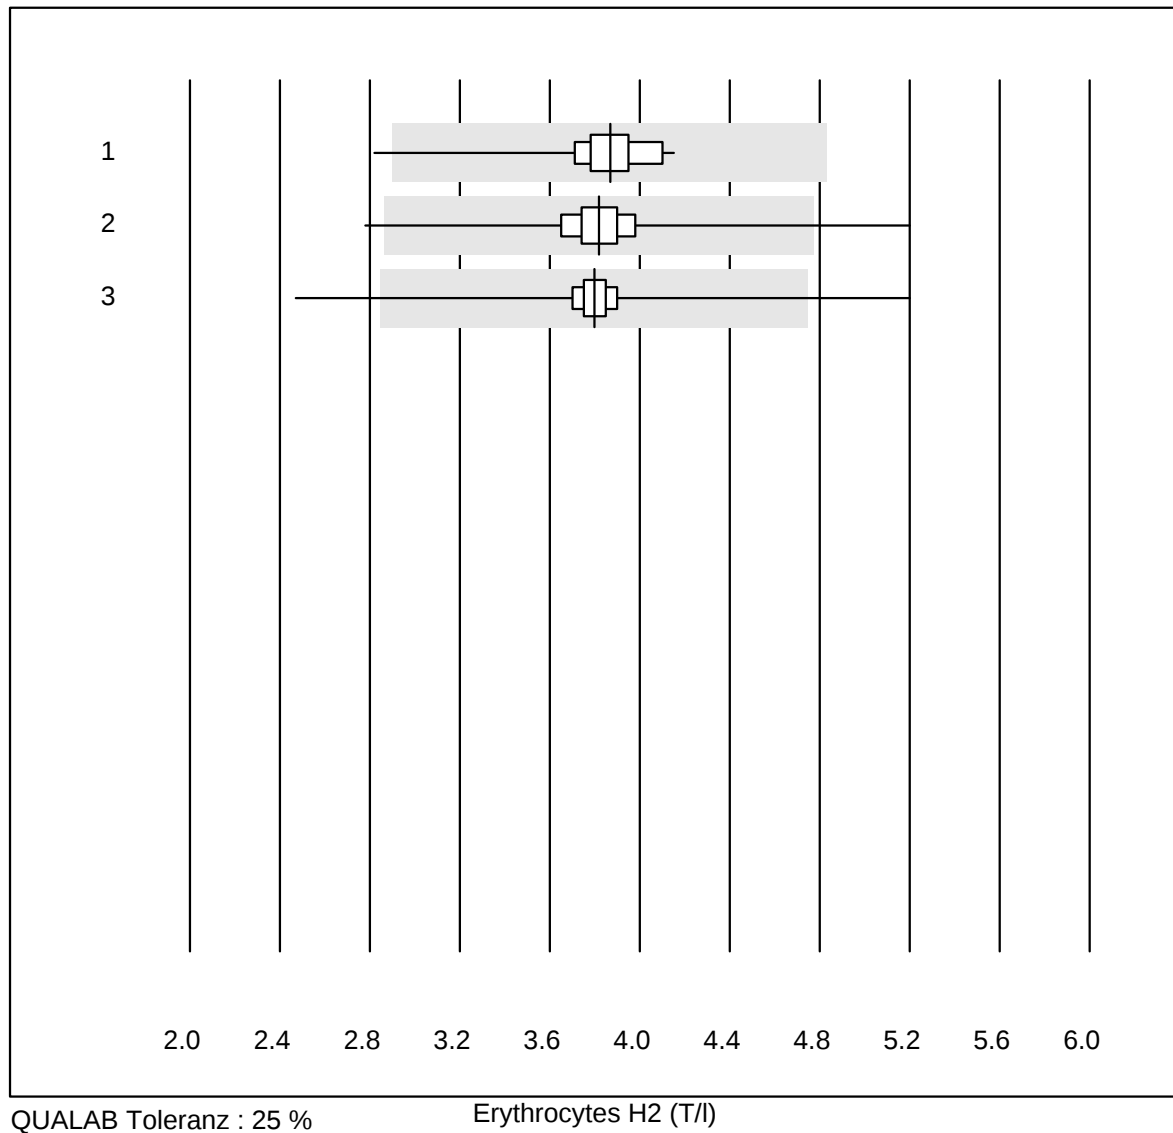

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Z3	58	98.3	1.7	0.0	3.87	4.9	e
2	Abx Micros	136	94.1	1.5	4.4	3.82	6.0	e
3	Microsemi	764	95.3	0.9	3.8	3.80	4.6	e

CRP H2

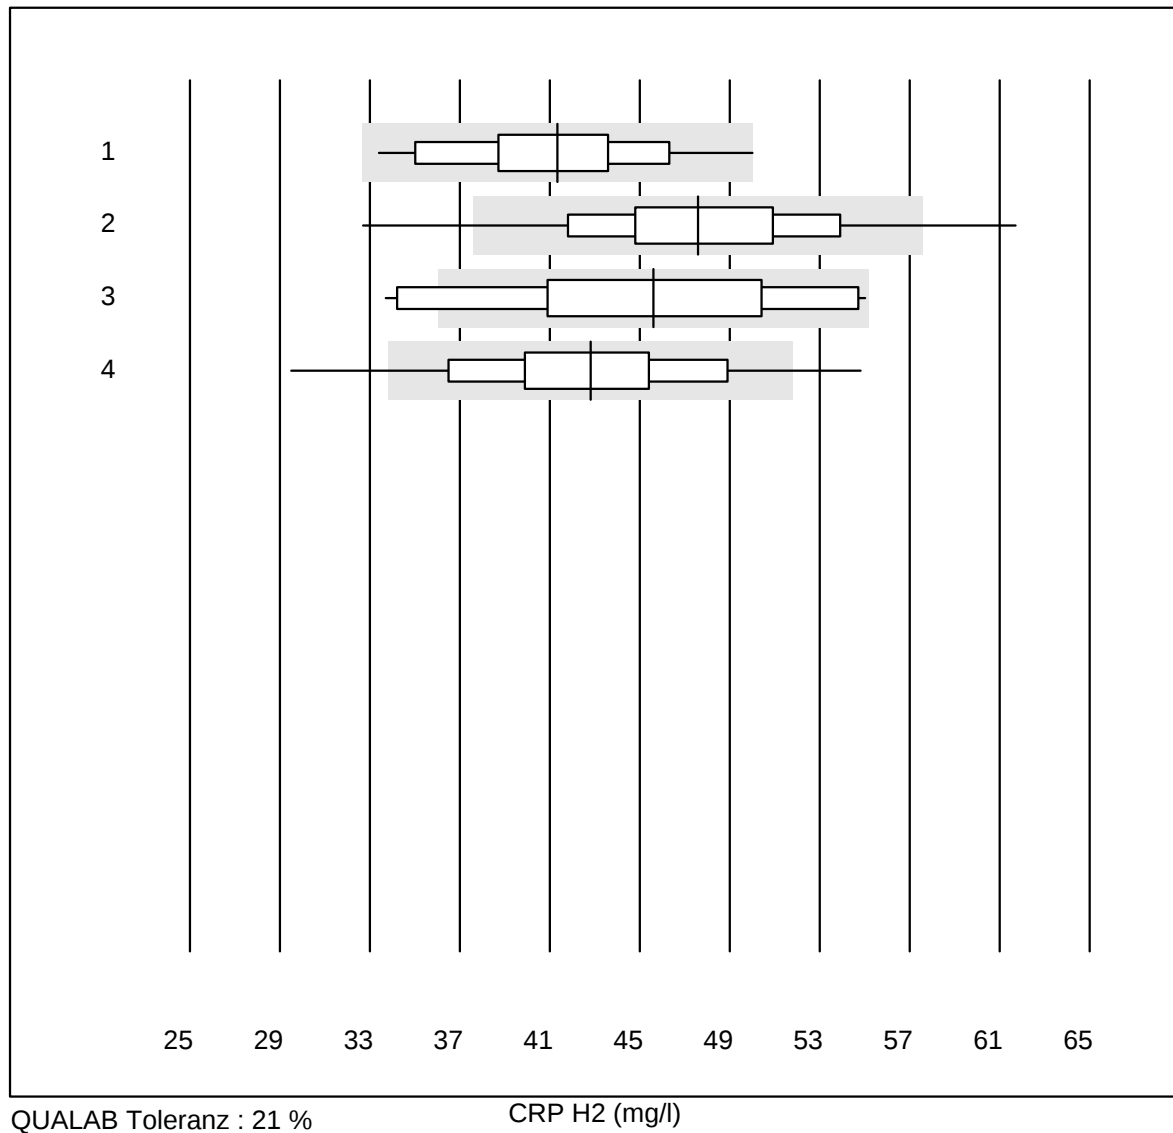


QUALAB Toleranz : 21 %

CRP H2 (mg/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Z3	51	94.1	0.0	5.9	41.3	9.7	e
2	Microsemi	754	92.8	4.0	3.2	47.6	10.0	e
3	Abx Micros	17	88.2	11.8	0.0	45.6	14.7	e*
4	ABX Micros CRP200	116	88.8	8.6	2.6	42.8	11.4	e

Hémoglobine BG

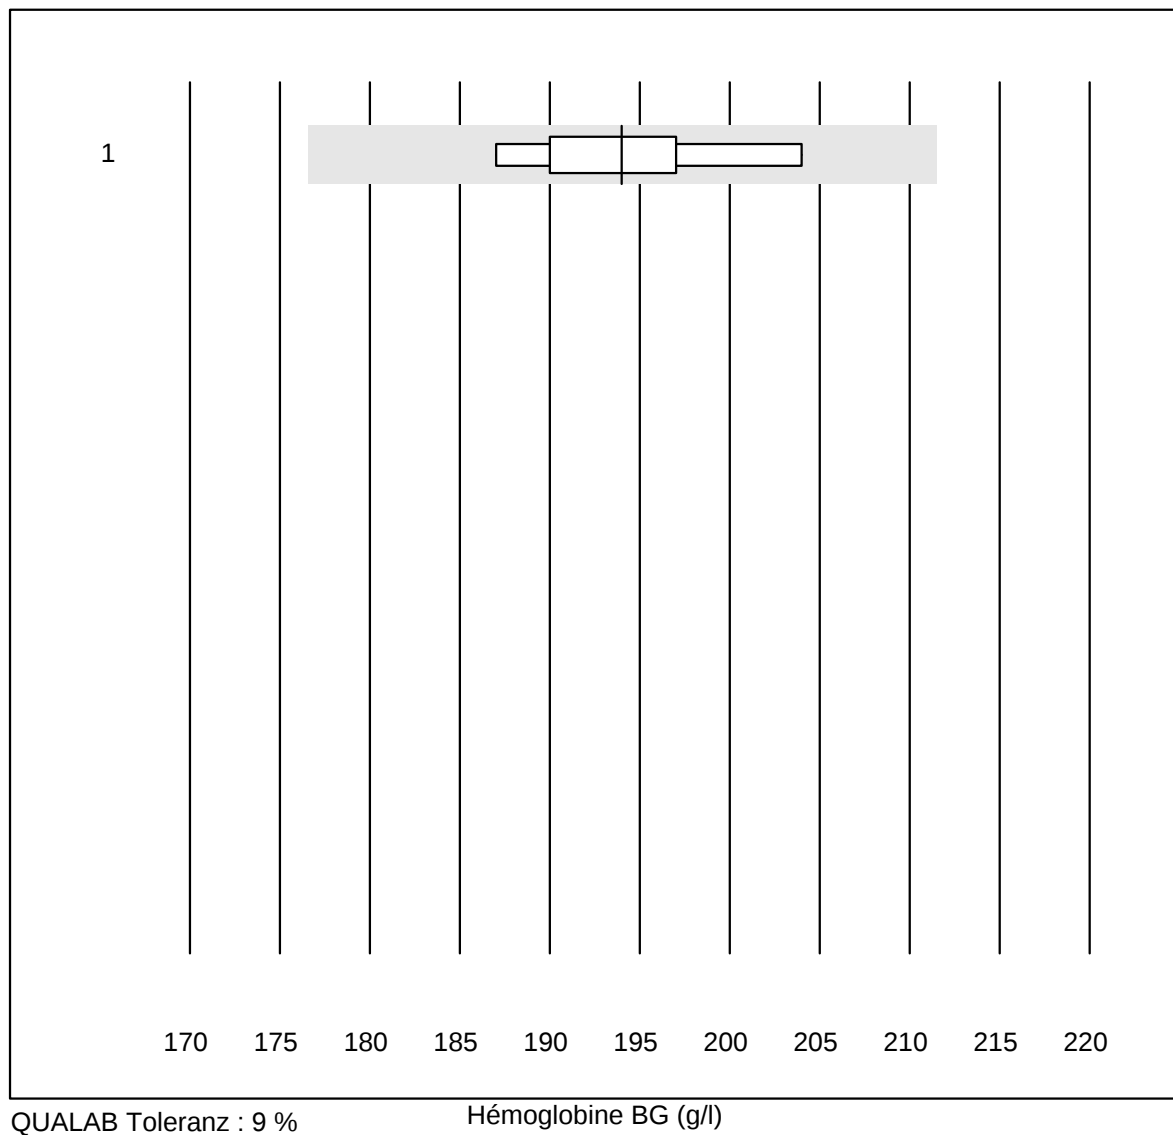

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 iStat	5	100.0	0.0	0.0	194.0	3.4	e*

Hématocrite

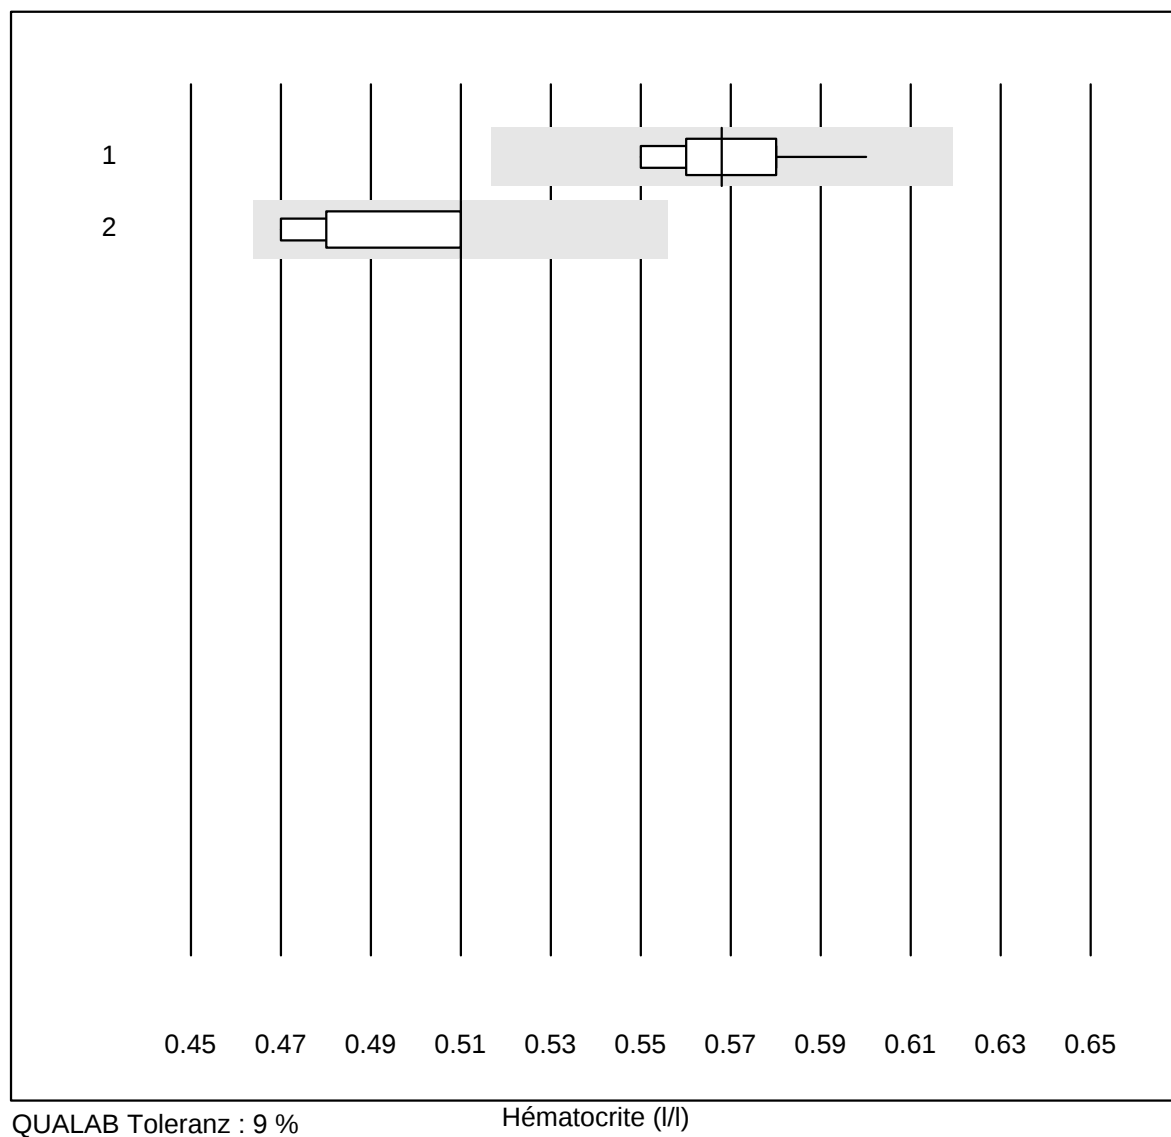


QUALAB Toleranz : 9 %

Hématocrite (l/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	iStat	10	100.0	0.0	0.0	0.57	2.7	e
2	EPOC	8	100.0	0.0	0.0	0.51	3.2	e*

Hémoglobine

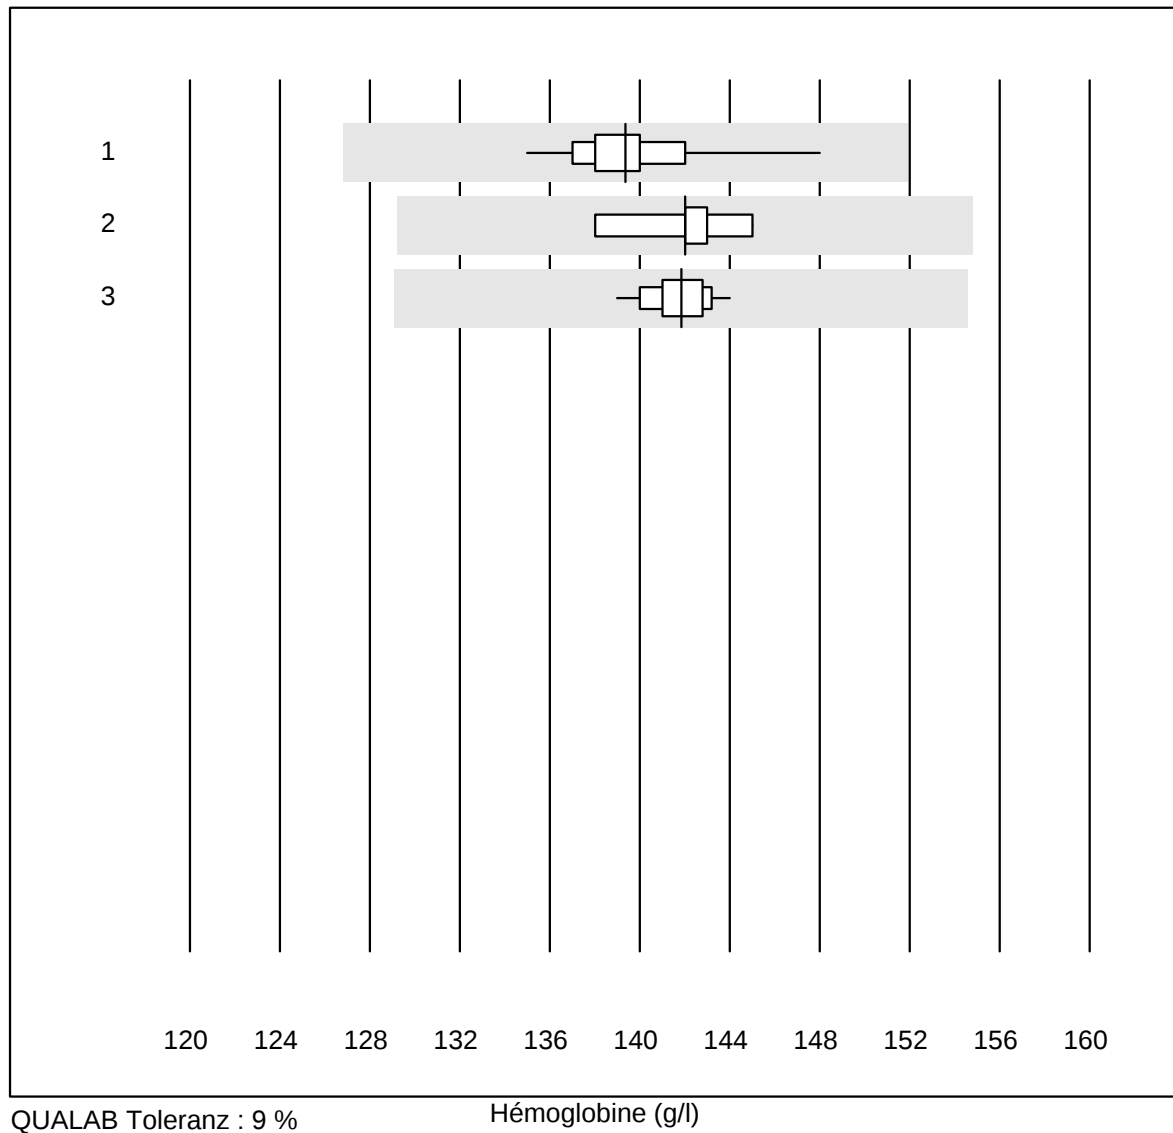


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex	72	100.0	0.0	0.0	139.3	1.6	e
2	Advia	5	100.0	0.0	0.0	142.0	1.8	e
3	Yumizen/Pentra	12	100.0	0.0	0.0	141.8	1.0	e

Hématocrite

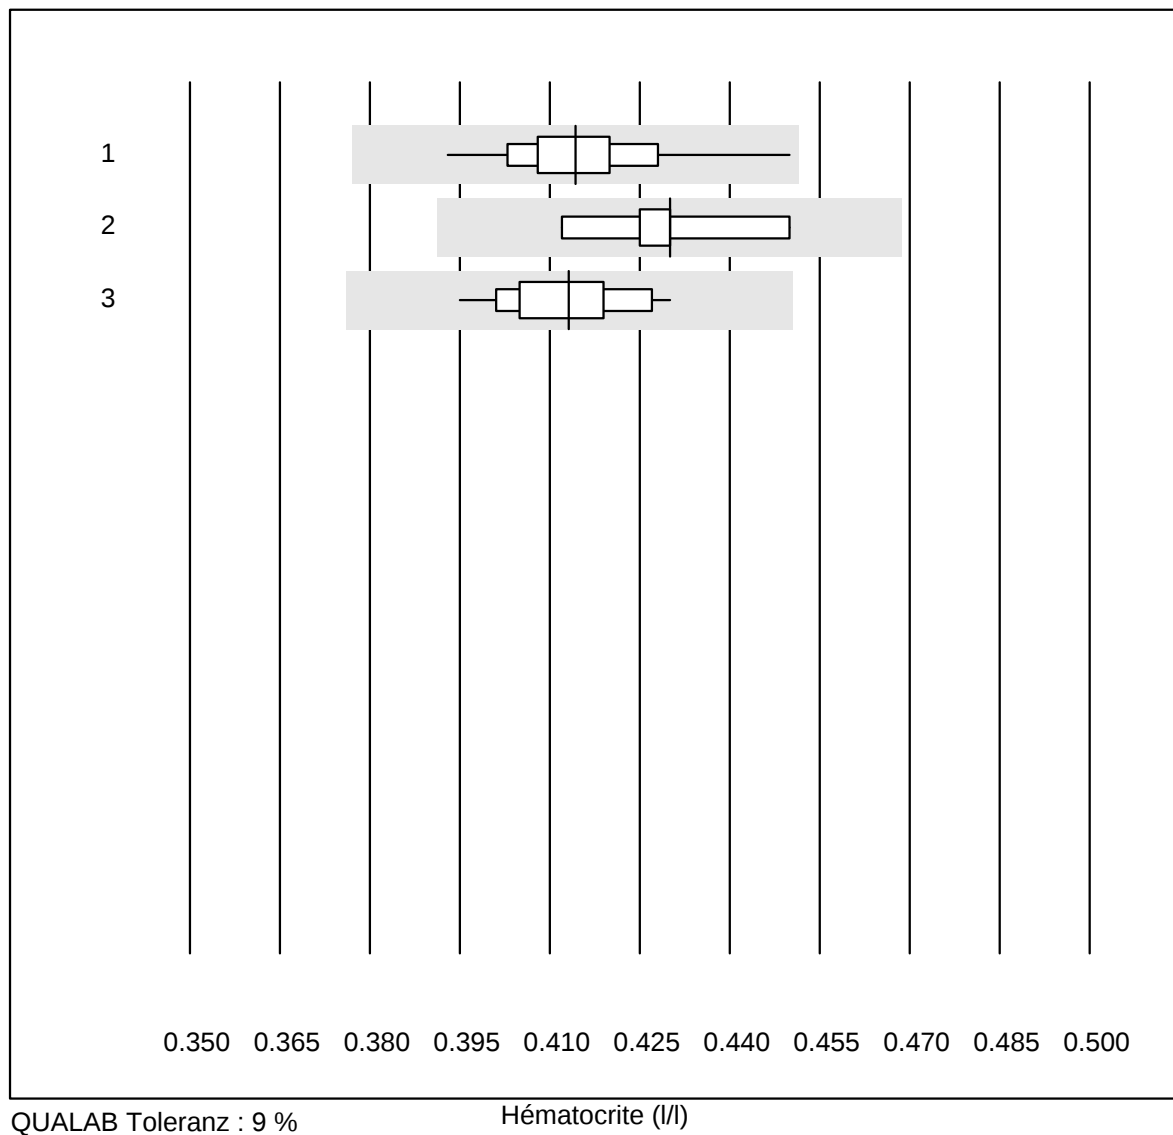

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex	72	98.6	0.0	1.4	0.41	2.4	e
2	Advia	5	100.0	0.0	0.0	0.43	3.2	e*
3	Yumizen/Pentra	12	100.0	0.0	0.0	0.41	2.6	e

Erythrocytes

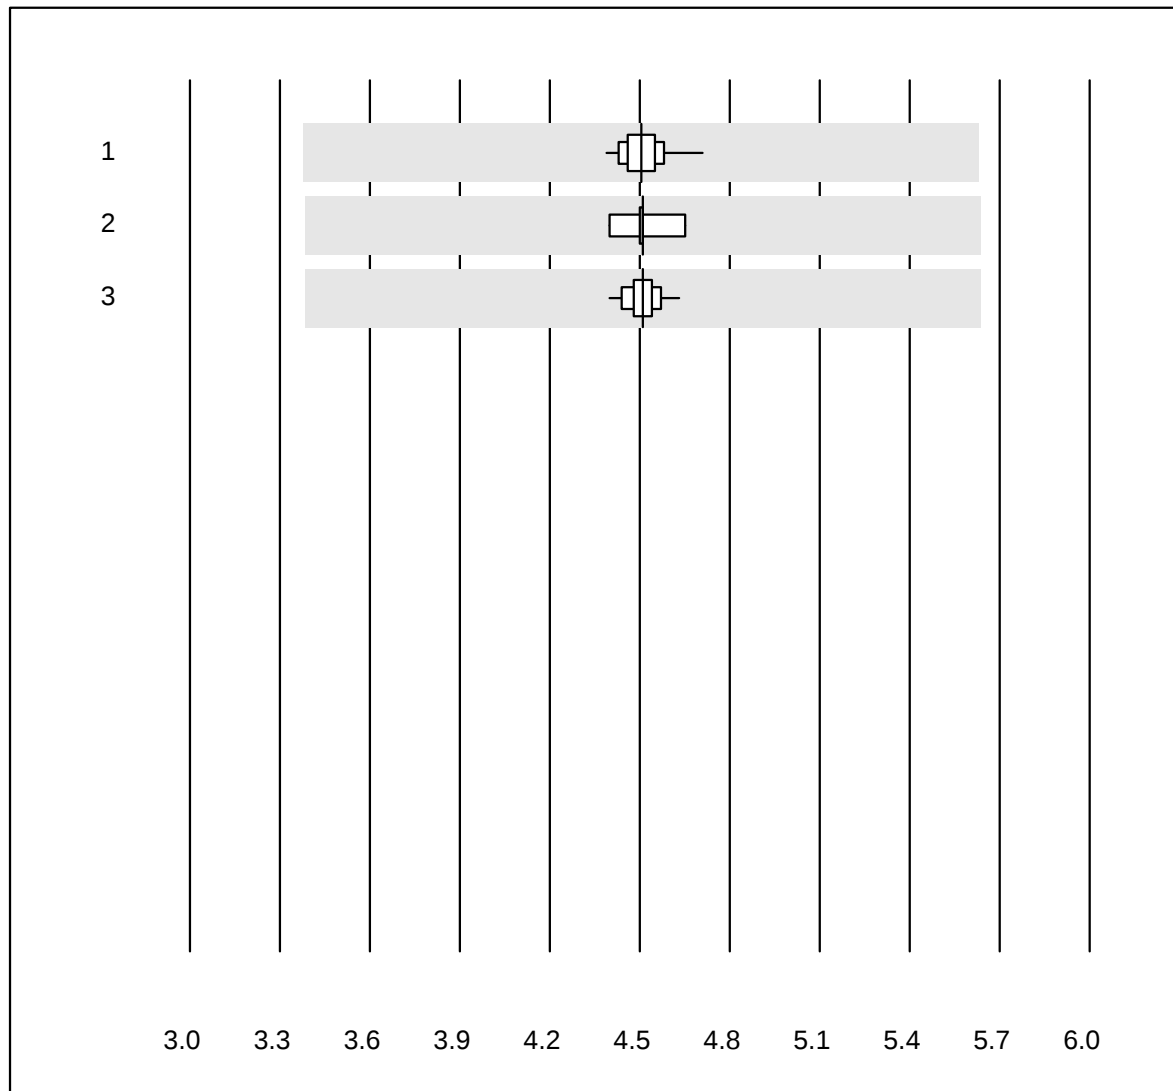


QUALAB Toleranz : 25 %

Erythrocytes (T/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex	72	100.0	0.0	0.0	4.50	1.5	e
2	Advia	5	100.0	0.0	0.0	4.51	2.0	e
3	Yumizen/Pentra	12	100.0	0.0	0.0	4.51	1.3	e

Leucocytes

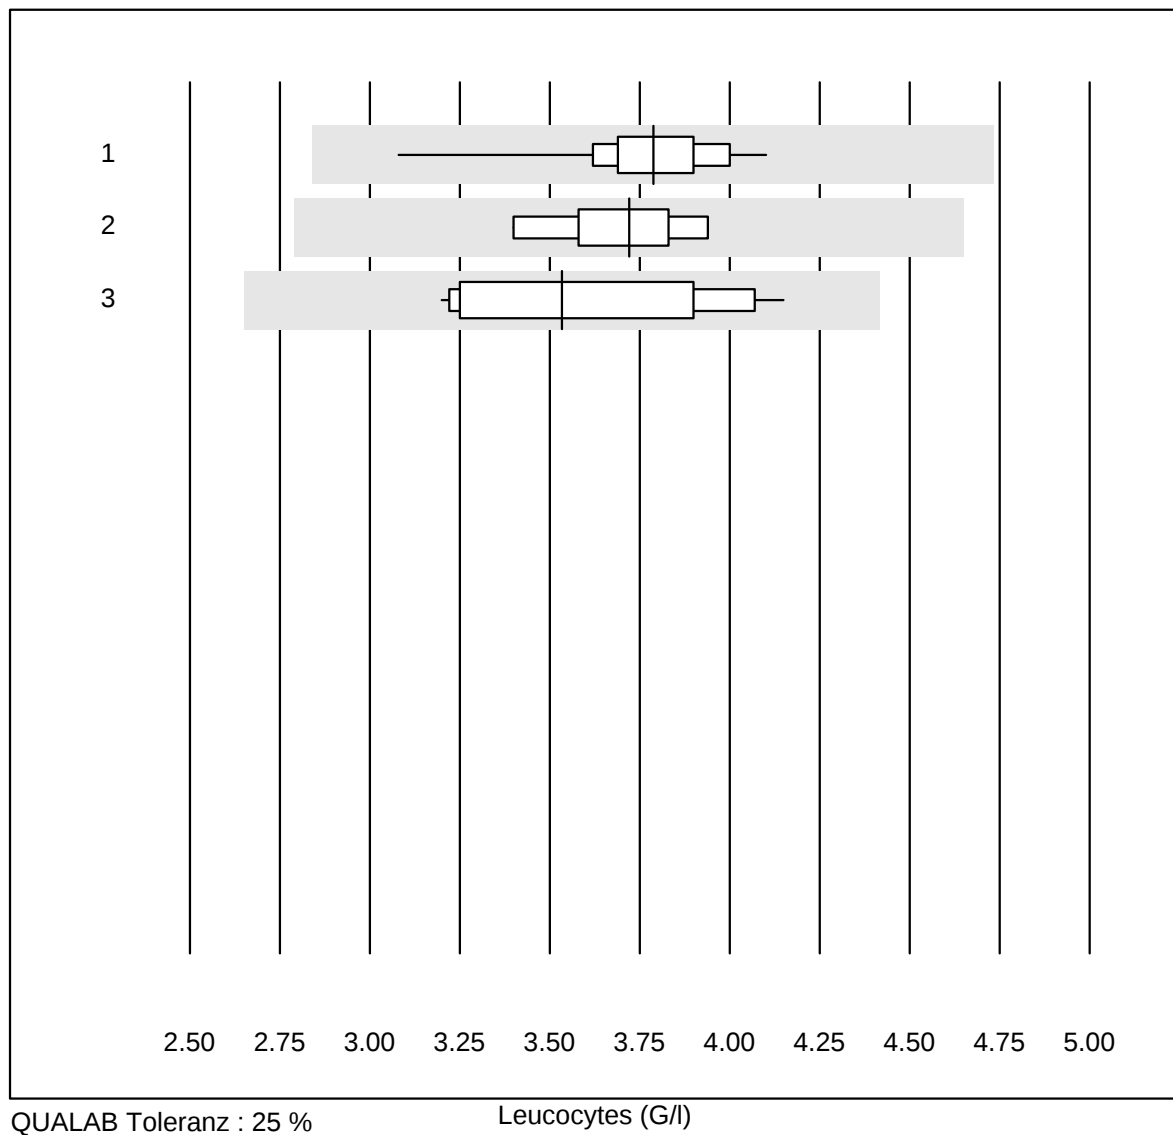


QUALAB Toleranz : 25 %

Leucocytes (G/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex	71	100.0	0.0	0.0	3.79	4.4	e
2	Advia	5	100.0	0.0	0.0	3.72	5.7	e
3	Yumizen/Pentra	12	91.7	0.0	8.3	3.53	9.9	e

Thrombocytes

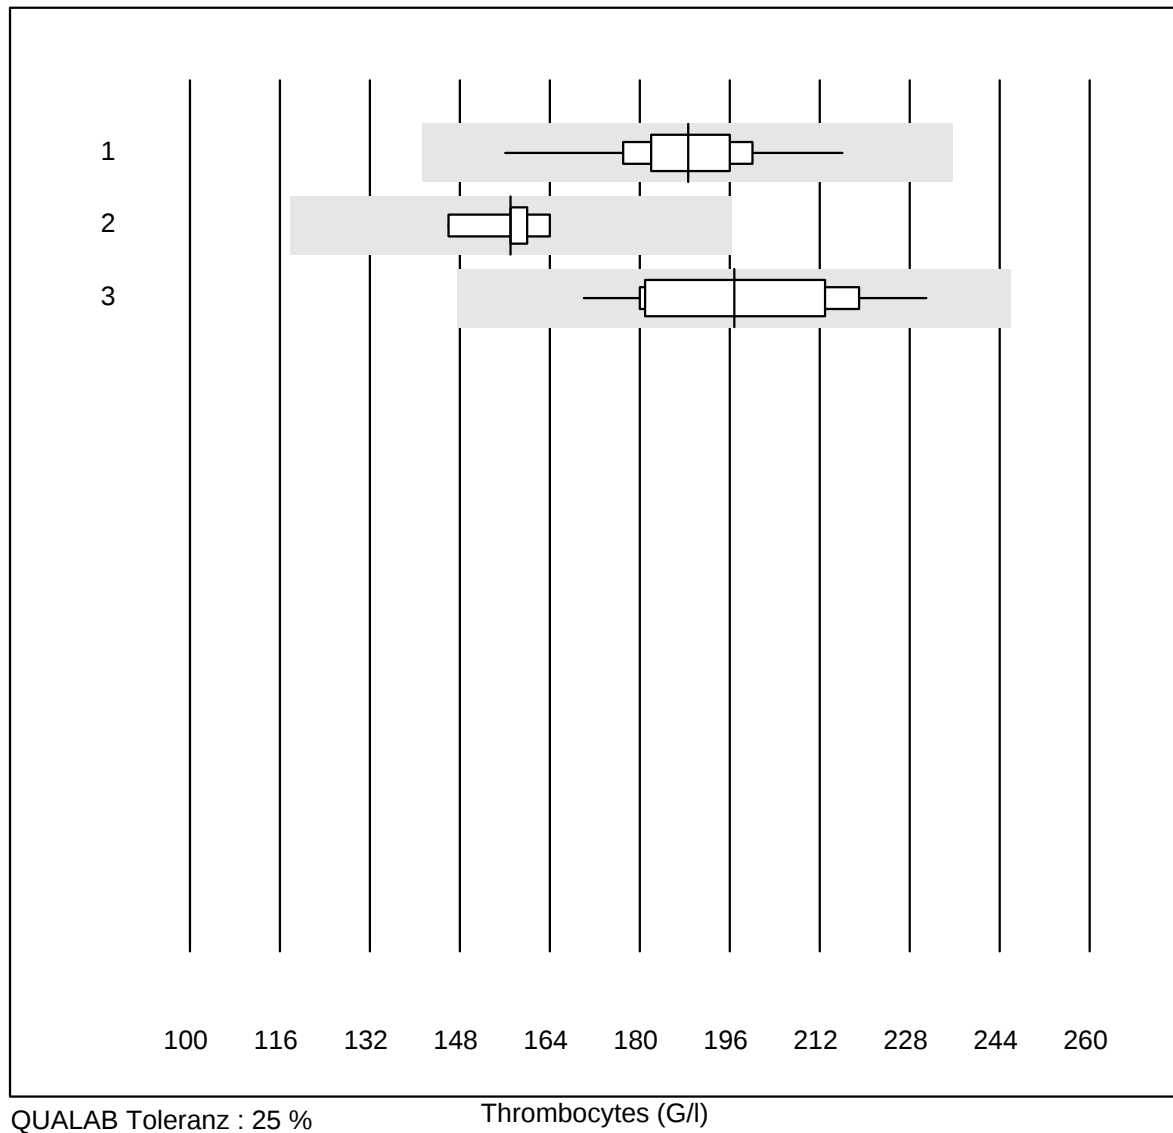


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex	72	100.0	0.0	0.0	188.6	5.7	e
2	Advia	5	100.0	0.0	0.0	157.0	4.3	e
3	Yumizen/Pentra	12	100.0	0.0	0.0	196.8	9.6	e

Neutrophiles

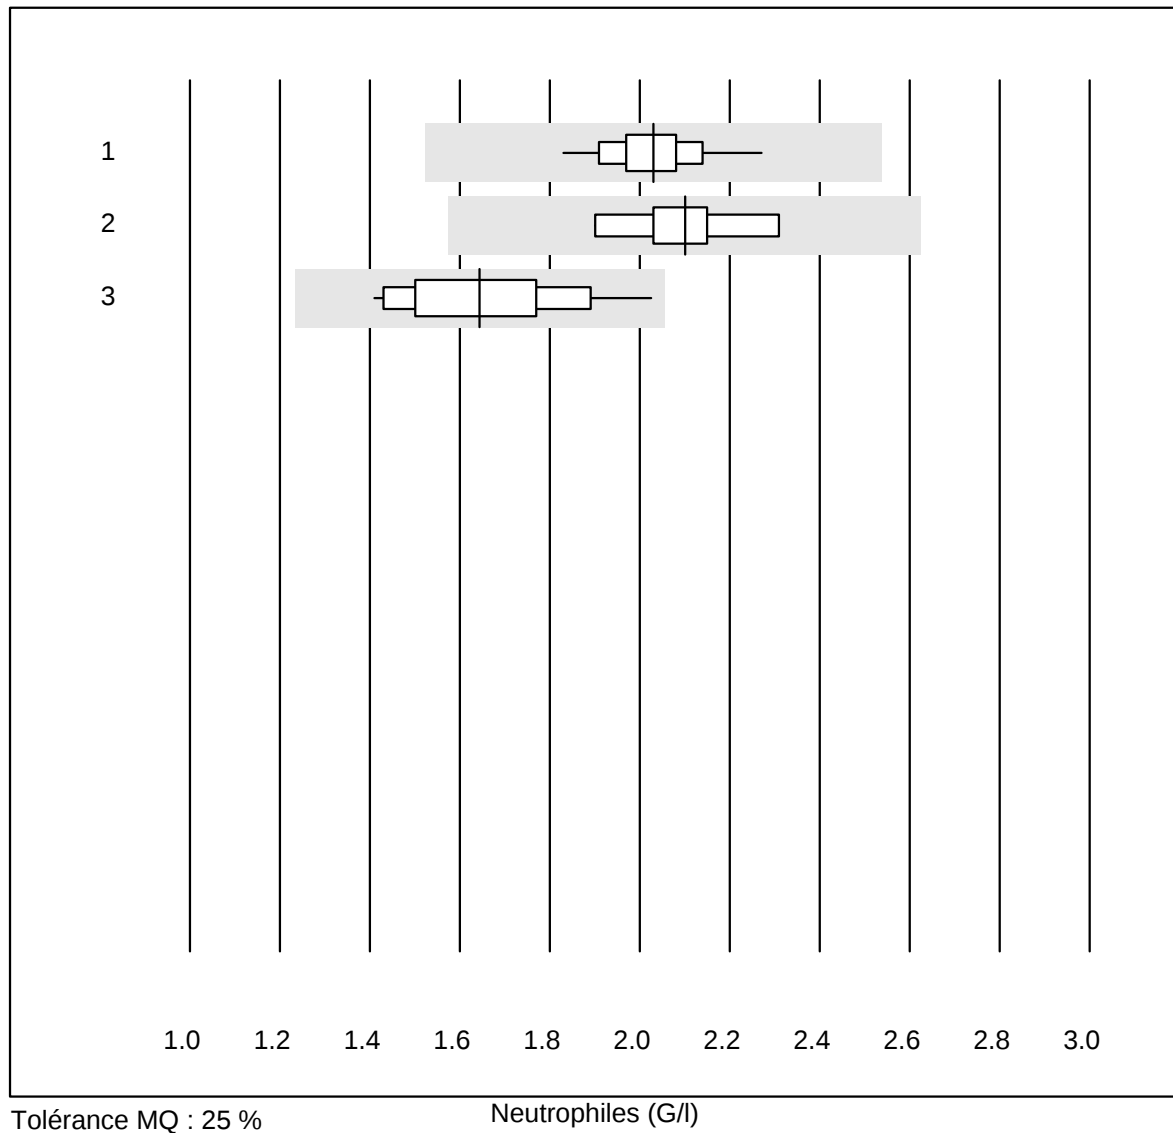


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex	72	98.6	0.0	1.4	2.03	4.4	e
2	Advia	5	100.0	0.0	0.0	2.10	7.2	e*
3	Yumizen/Pentra	12	91.7	0.0	8.3	1.64	11.7	e*

Lymphocytes

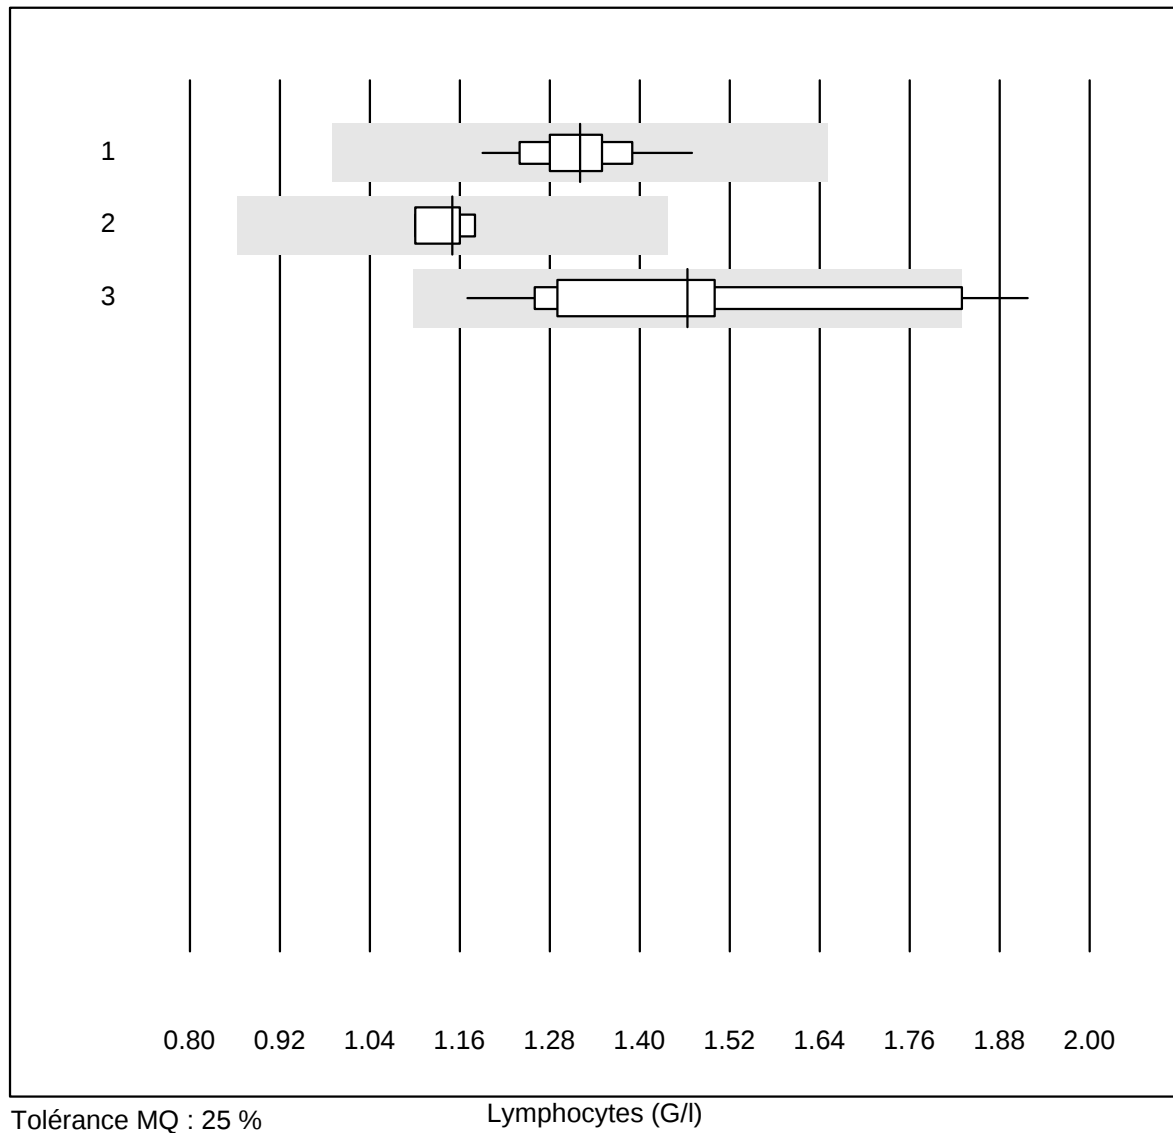


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex	72	100.0	0.0	0.0	1.32	4.5	e
2	Advia	5	100.0	0.0	0.0	1.15	3.2	e
3	Yumizen/Pentra	12	83.3	16.7	0.0	1.46	15.3	e*

Monocytes

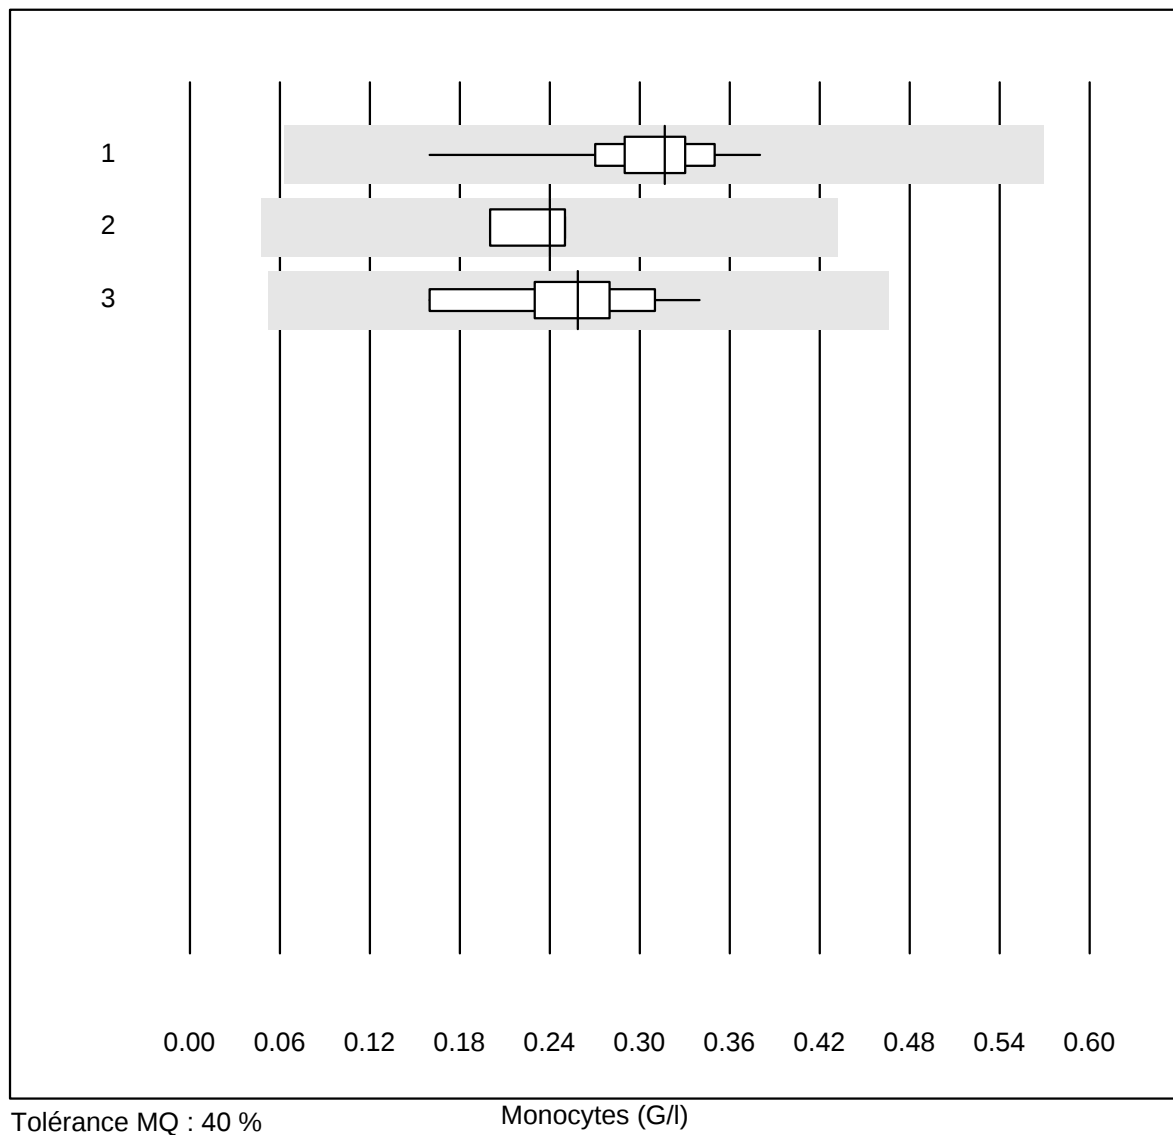


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex	72	100.0	0.0	0.0	0.32	11.3	a
2	Advia	4	100.0	0.0	0.0	0.24	10.2	a
3	Yumizen/Pentra	11	90.9	0.0	9.1	0.26	19.2	a

Eosinophiles

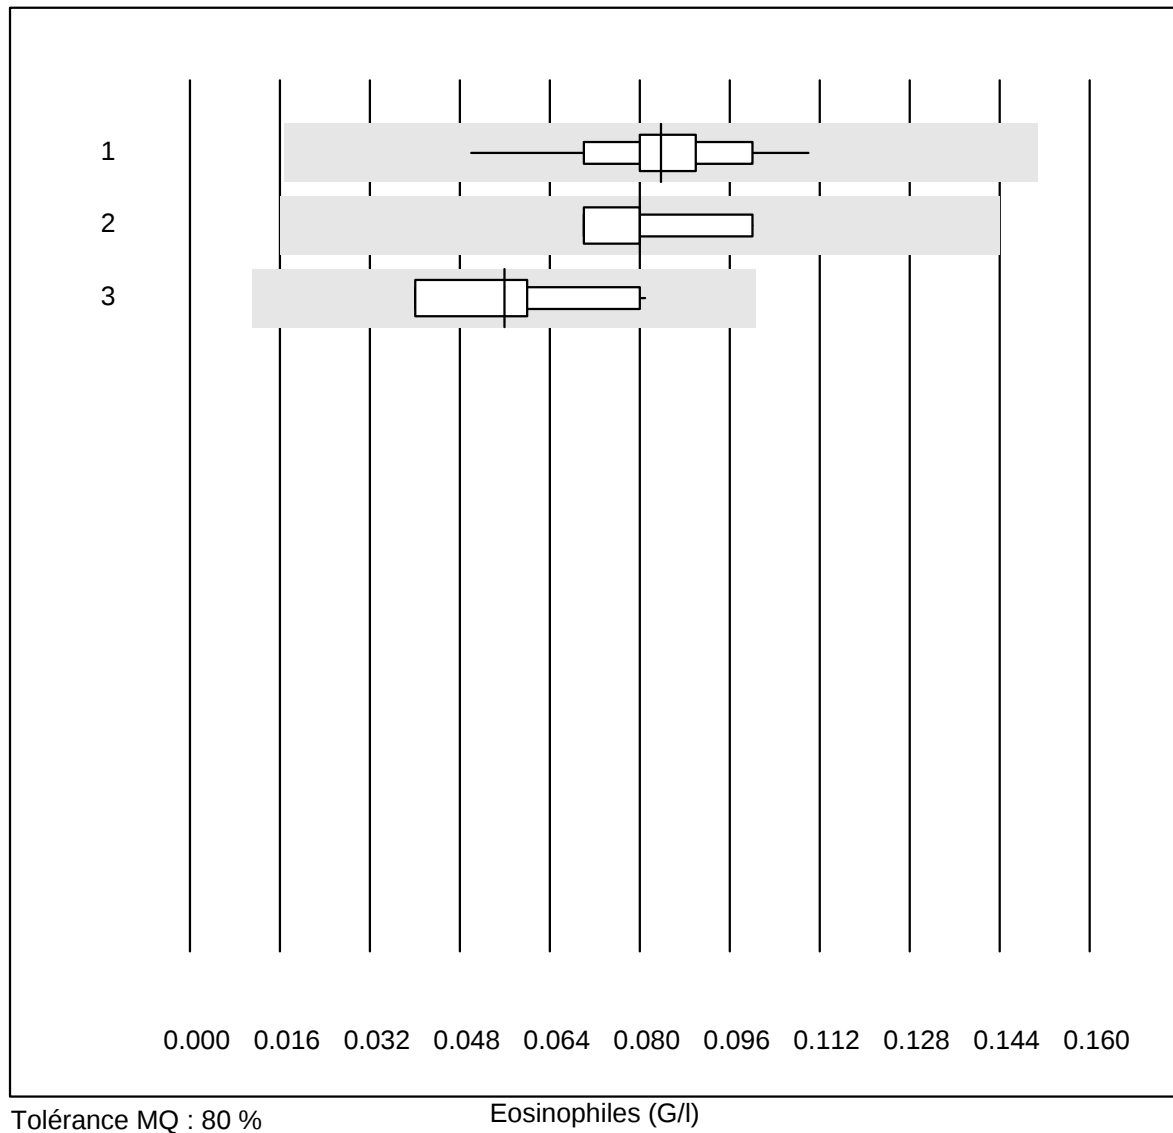

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex	72	98.6	0.0	1.4	0.08	14.5	e
2	Advia	5	100.0	0.0	0.0	0.08	15.3	e
3	Yumizen/Pentra	12	100.0	0.0	0.0	0.06	26.1	e

Basophiles

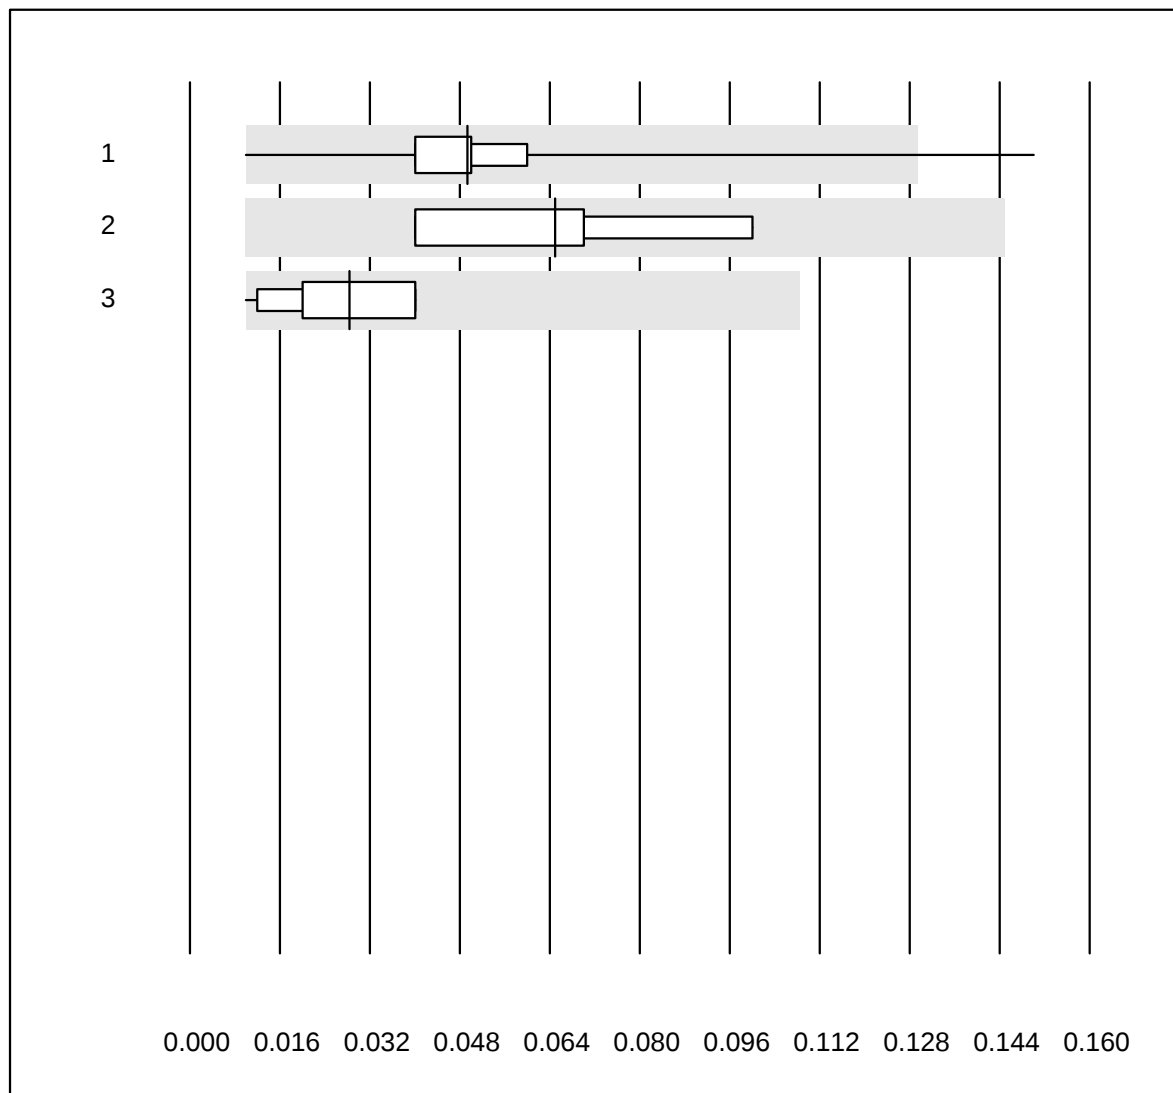


Tolérance MQ : 80 %
(< 0.10: +/- 0.08 G/l)

Basophiles (G/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex	72	98.6	1.4	0.0	0.05	35.1	e
2	Advia	4	100.0	0.0	0.0	0.07	37.0	e*
3	Yumizen/Pentra	12	91.7	0.0	8.3	0.03	36.9	e*

MCV

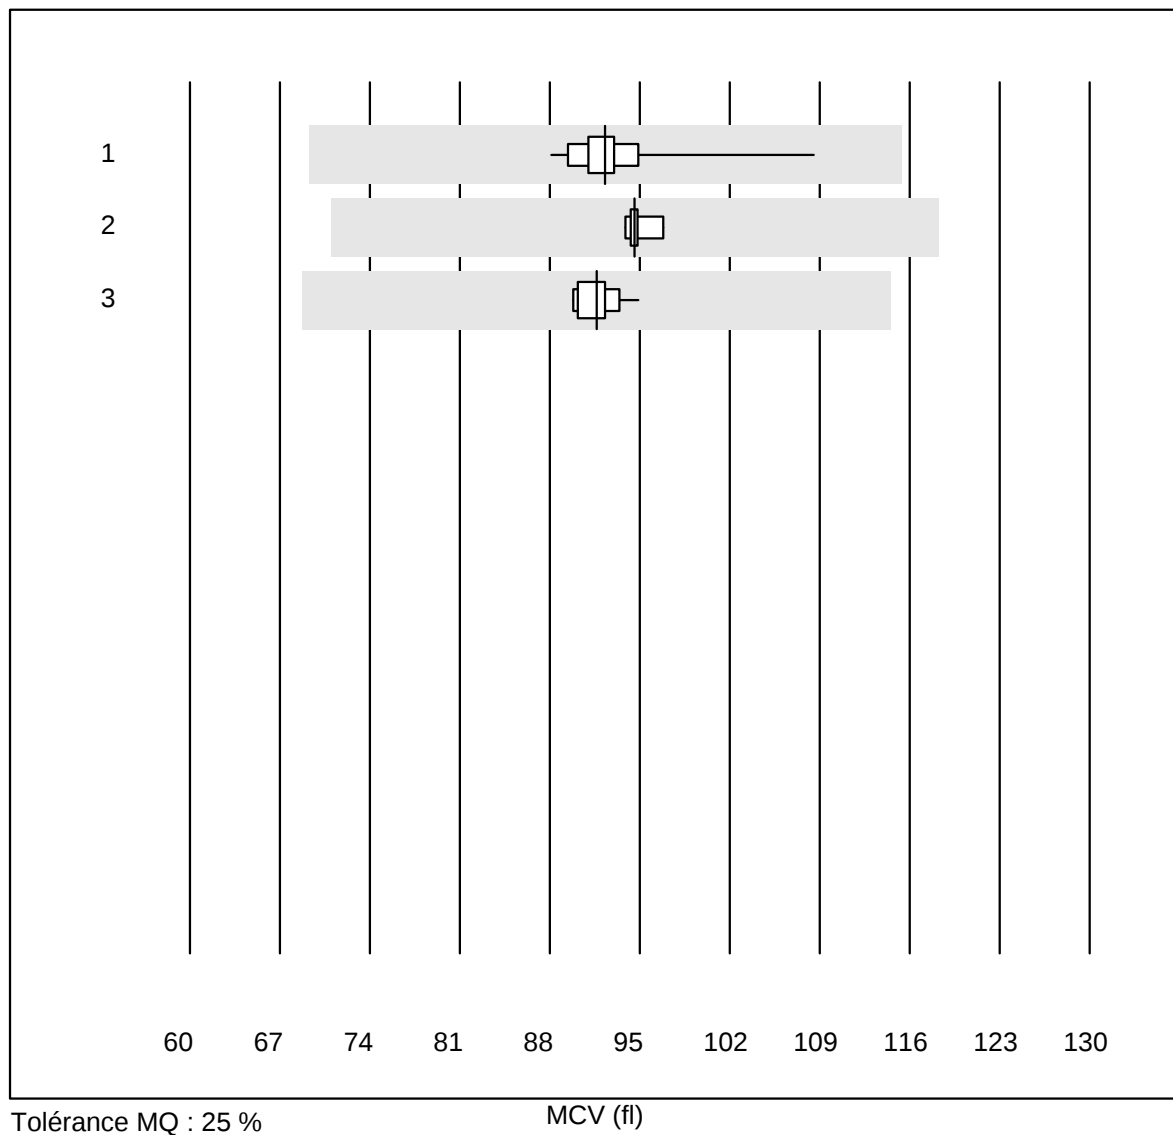


Tolérance MQ : 25 %

MCV (fl)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex	65	100.0	0.0	0.0	92.3	3.1	e
2	Advia	5	100.0	0.0	0.0	94.6	1.2	e
3	Yumizen/Pentra	10	100.0	0.0	0.0	91.6	1.8	e

MCH

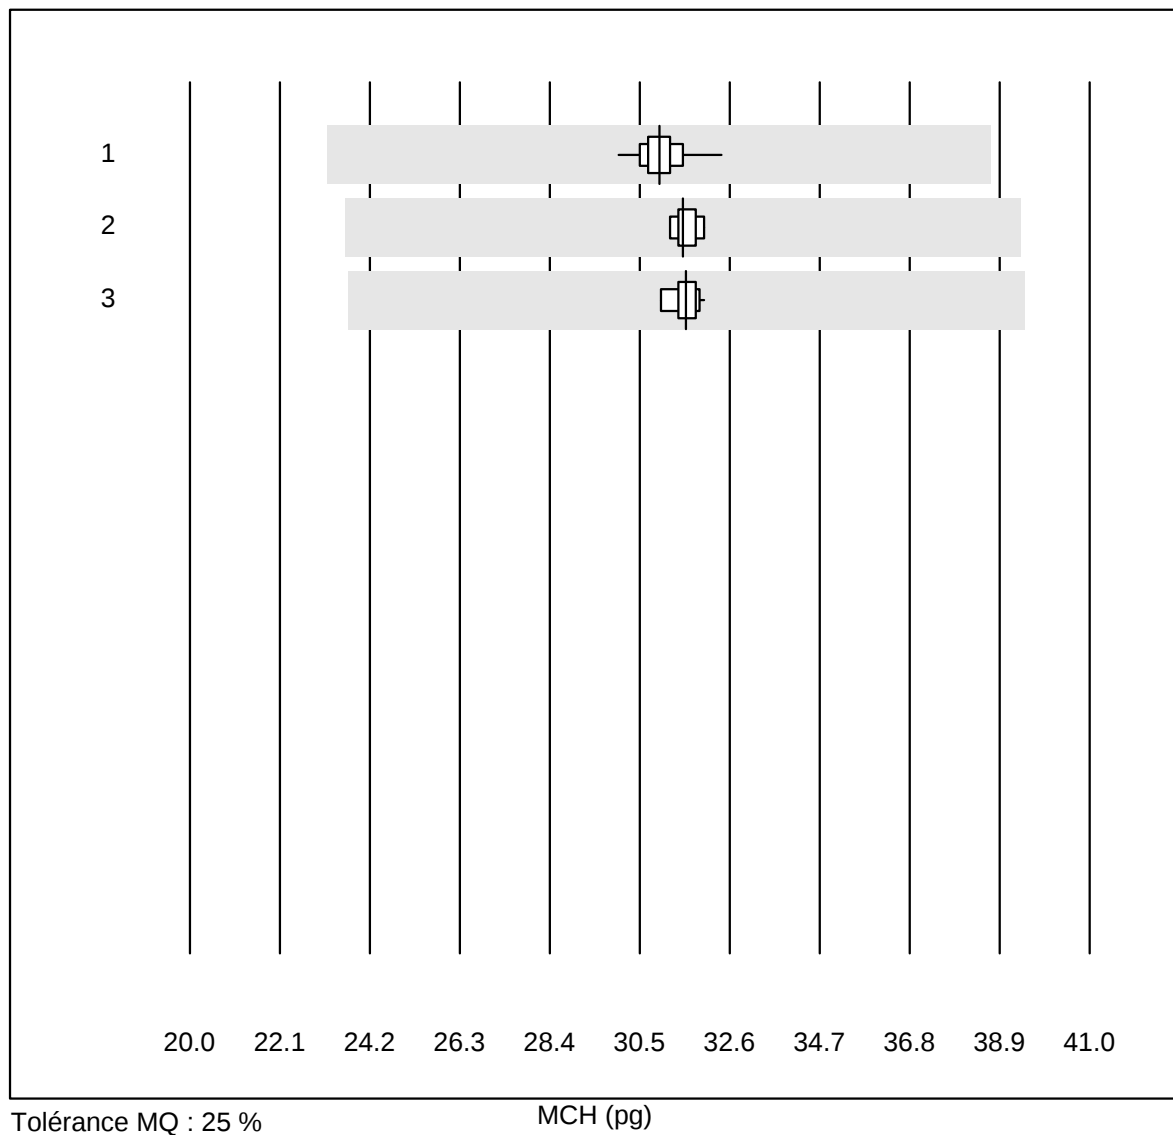

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex	64	100.0	0.0	0.0	31.0	1.3	e
2	Advia	5	100.0	0.0	0.0	31.5	1.0	e
3	Yumizen/Pentra	10	100.0	0.0	0.0	31.6	1.0	e

MCHC

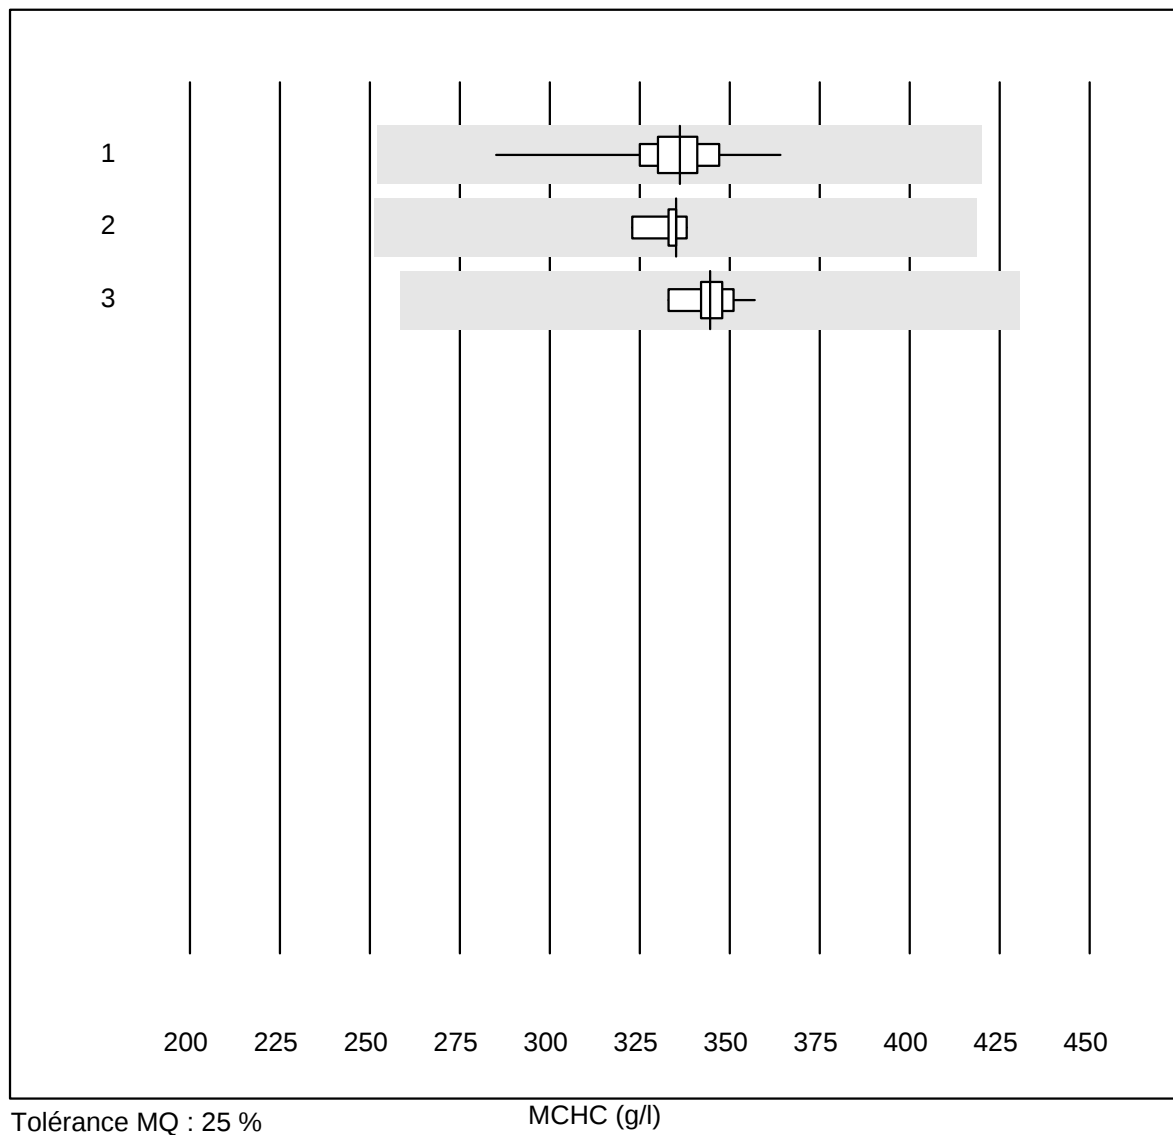


Tolérance MQ : 25 %

MCHC (g/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex	65	98.5	0.0	1.5	336	3.4	e
2	Advia	5	100.0	0.0	0.0	335	1.7	e
3	Yumizen/Pentra	10	100.0	0.0	0.0	344	2.0	e

RDW

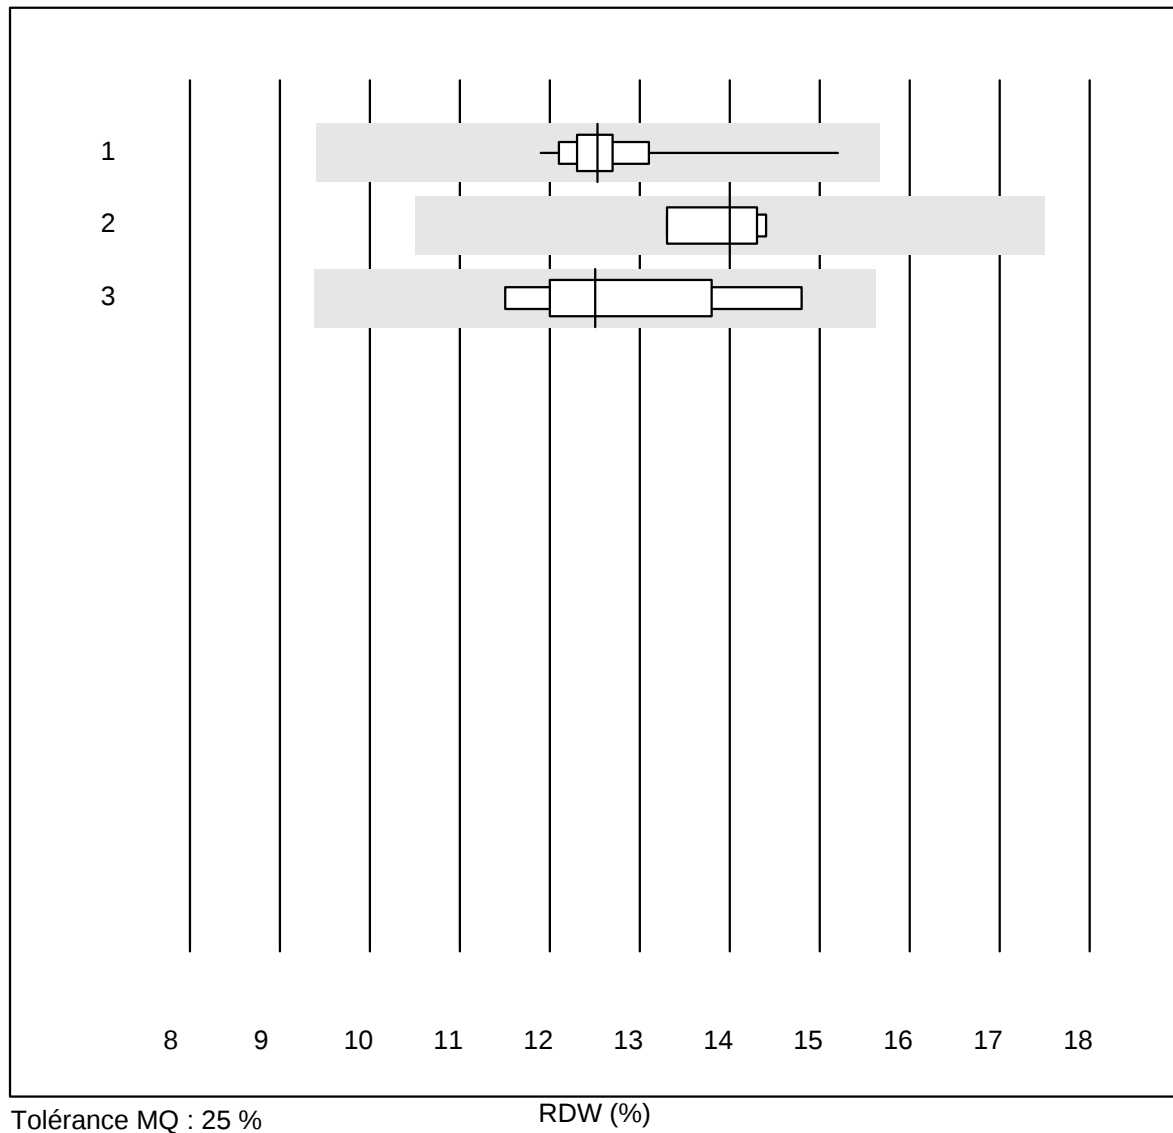


Tolérance MQ : 25 %

RDW (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex	64	100.0	0.0	0.0	12.5	3.8	e
2	Advia	4	100.0	0.0	0.0	14.0	3.7	e
3	Yumizen/Pentra	9	100.0	0.0	0.0	12.5	8.9	e

Immature Granulocytes

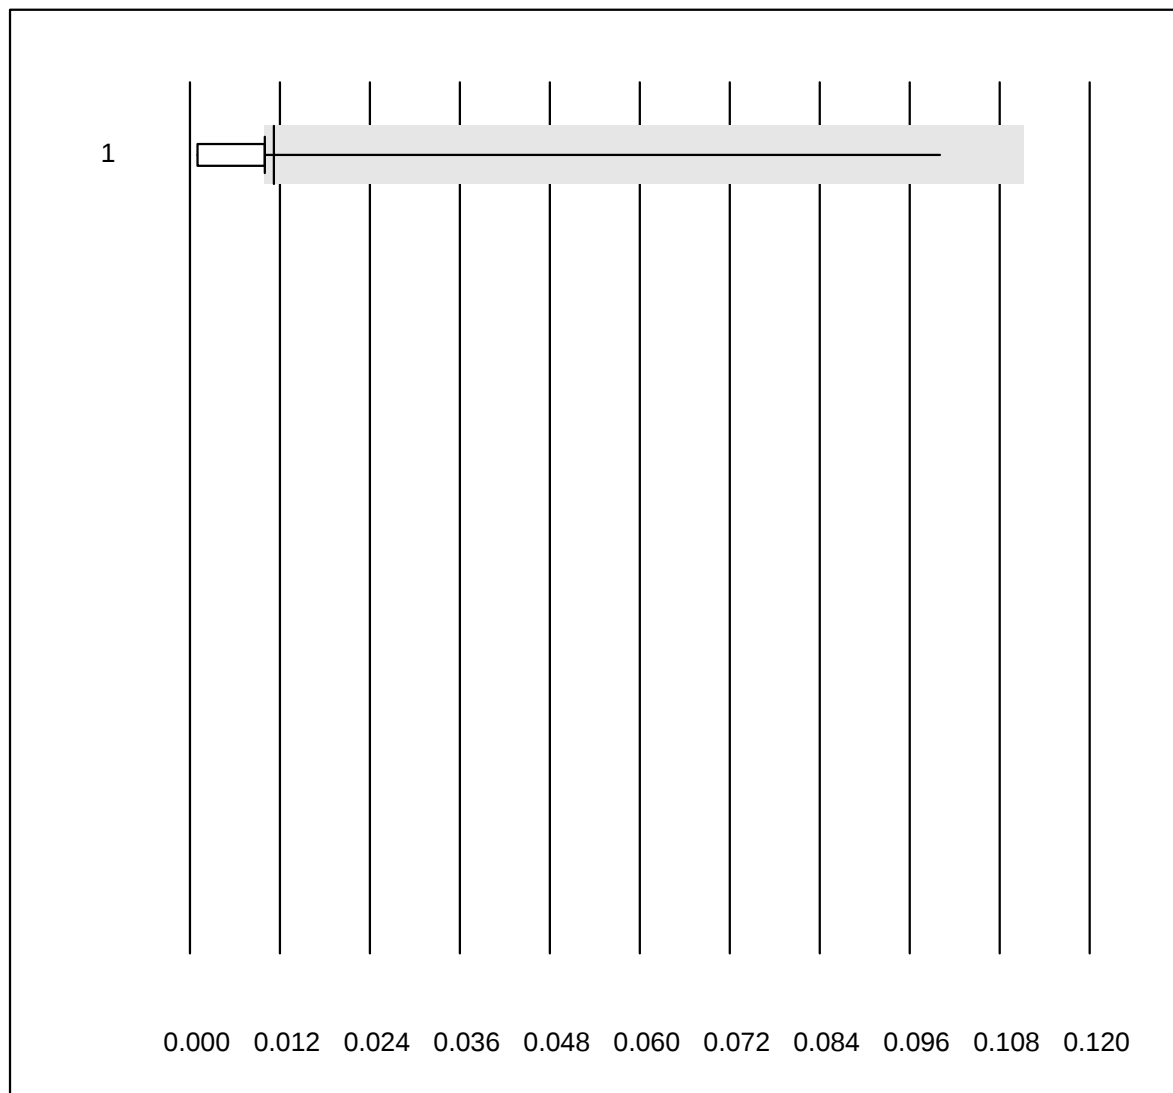


Tolérance MQ : 25 %
(< 0.10: +/- 0.10 G/l)

Immature Granulocytes (G/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex	41	97.6	0.0	2.4	0.01	134.5	e*

Réticulocytes

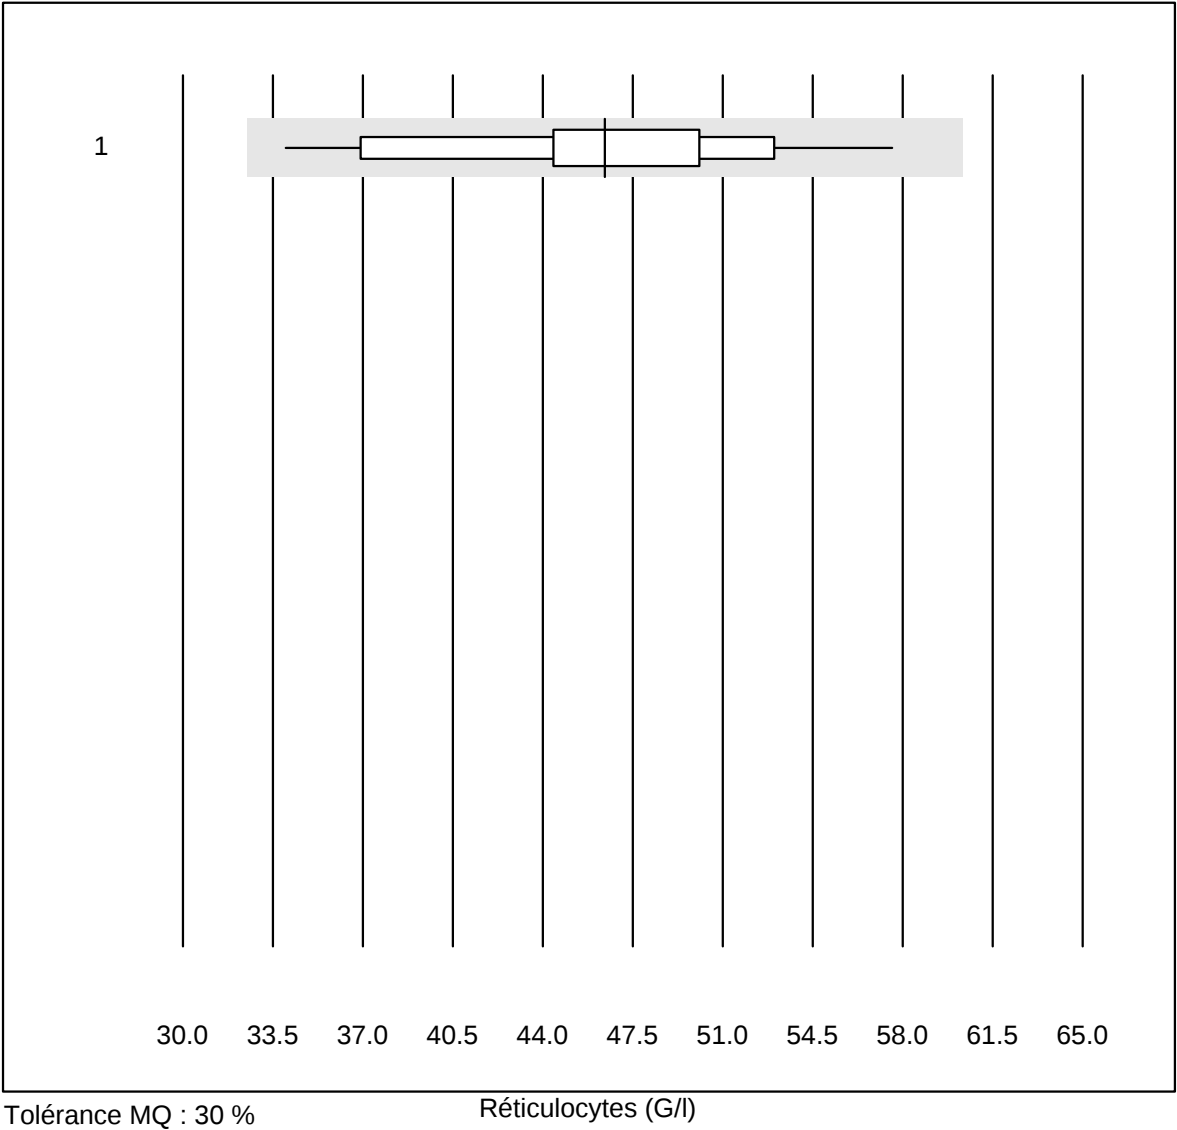

Nr. Methode		Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex	38	100.0	0.0	0.0	46.4	12.0	e

Index hémolytique échantillon A

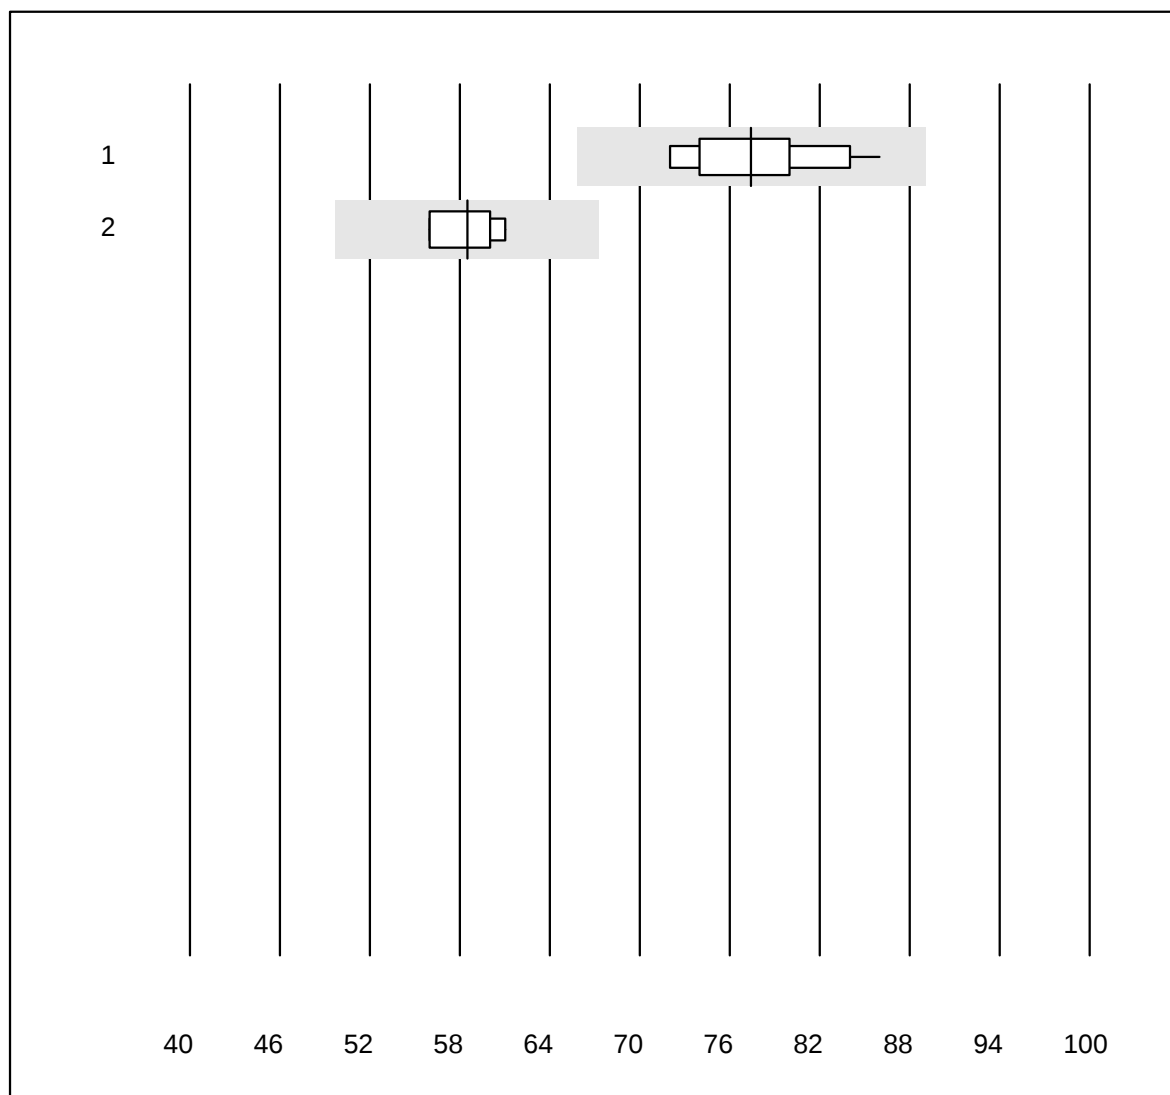


Tolérance MQ : 15 %

Index hémolytique échantillon A ()

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas	14	100.0	0.0	0.0	77.43	5.8	e
2	Architect	4	100.0	0.0	0.0	58.50	4.1	e*

Index hémolytique échantillon B

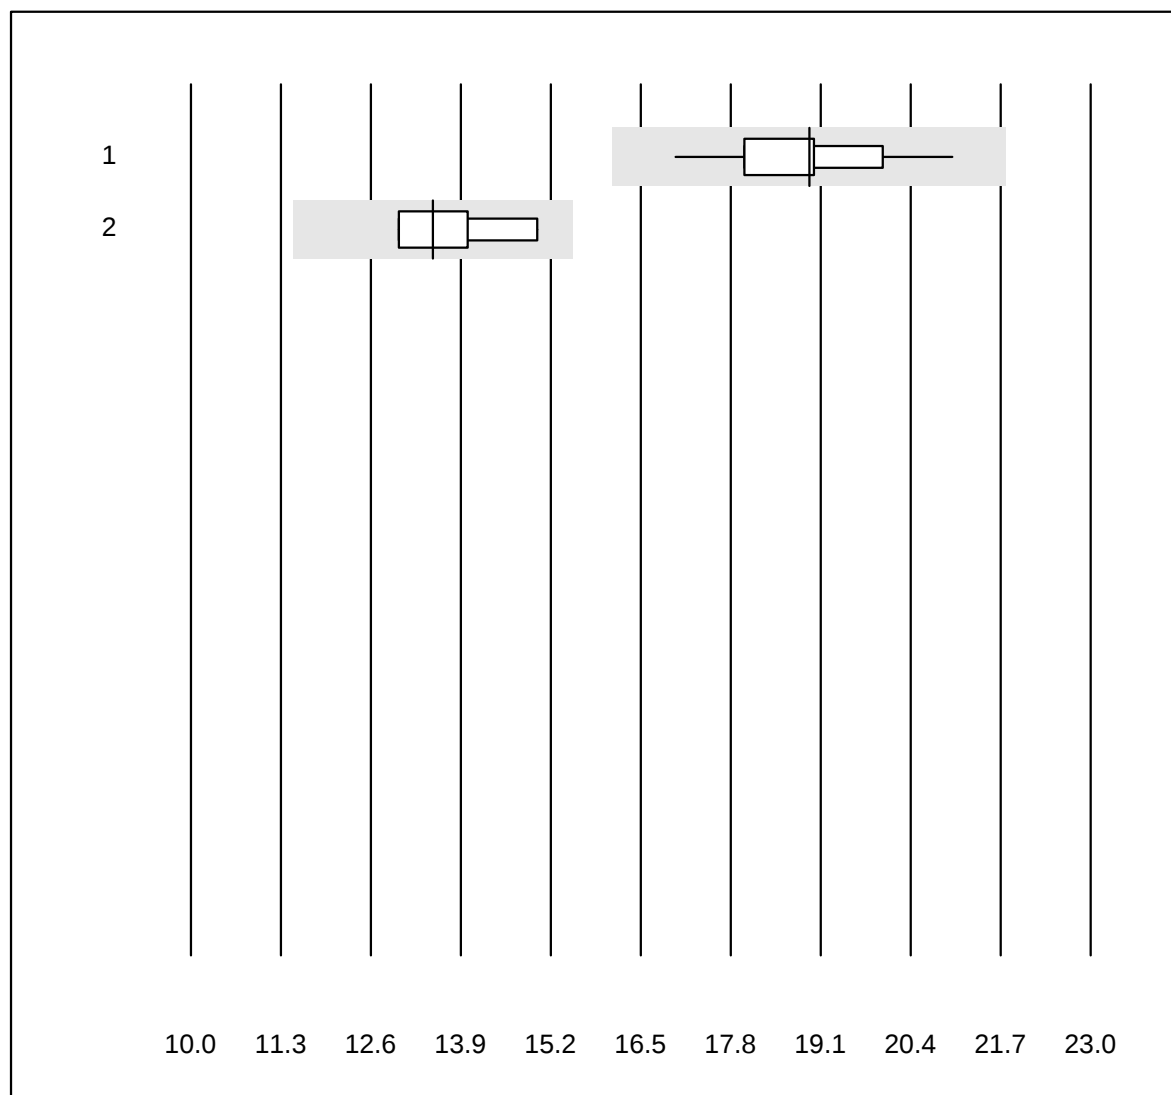


Tolérance MQ : 15 %

Index hémolytique échantillon B ()


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas	16	100.0	0.0	0.0	18.94	5.3	e
2	Architect	4	100.0	0.0	0.0	13.50	7.0	e*

Vitesse de sédimentation 1h

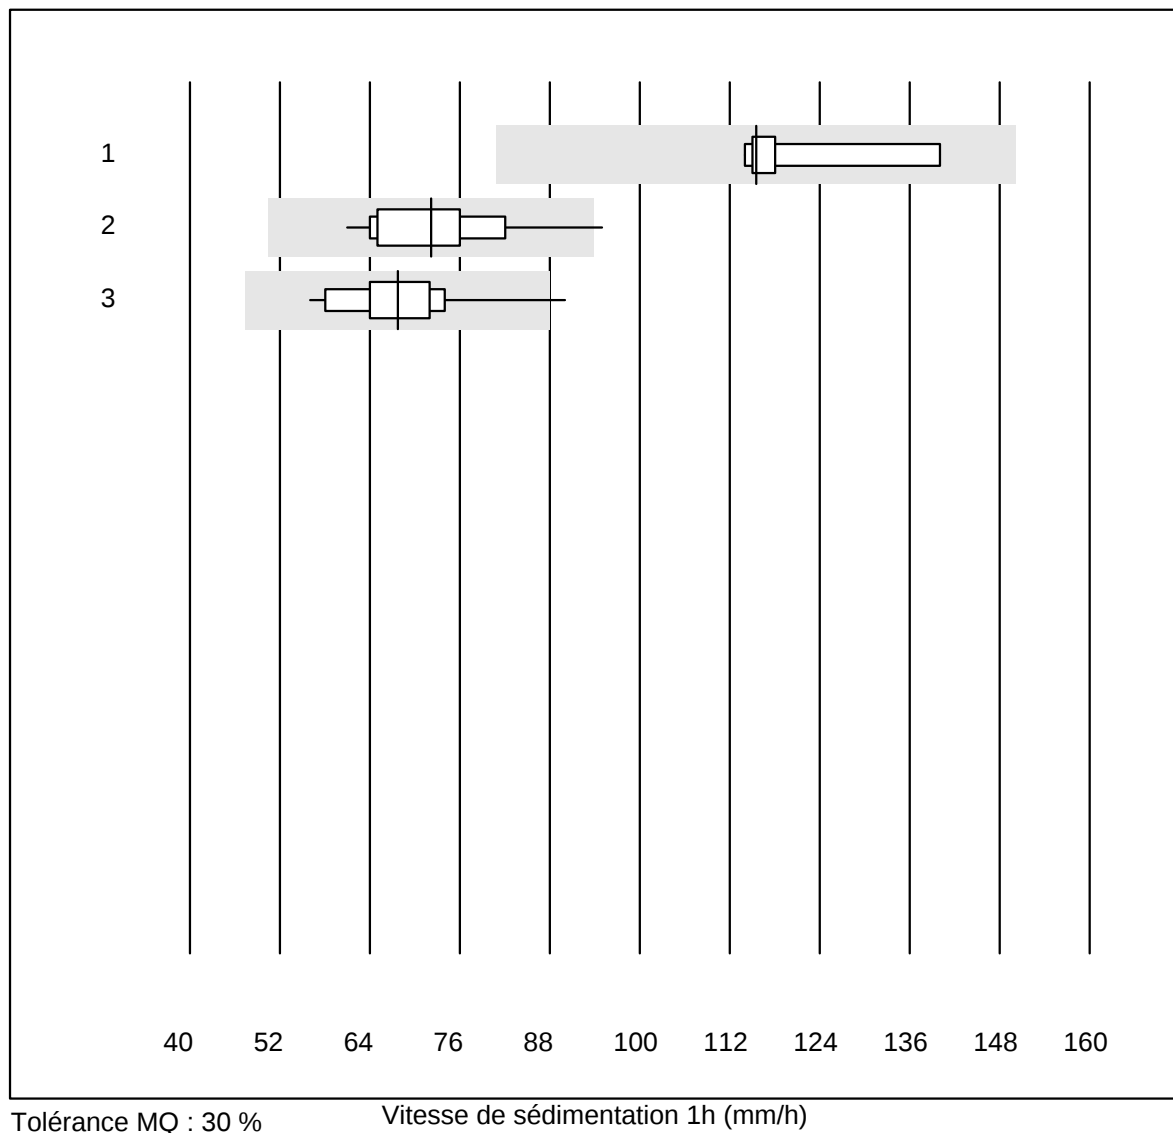

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	MINI-CUBE	6	100.0	0.0	0.0	116	8.4	e
2	Sarstedt Sedivette	12	91.7	8.3	0.0	72	13.1	e*
3	BD Seditainer	35	94.2	2.9	2.9	68	10.7	e

Vitesse de sédimentation 2h

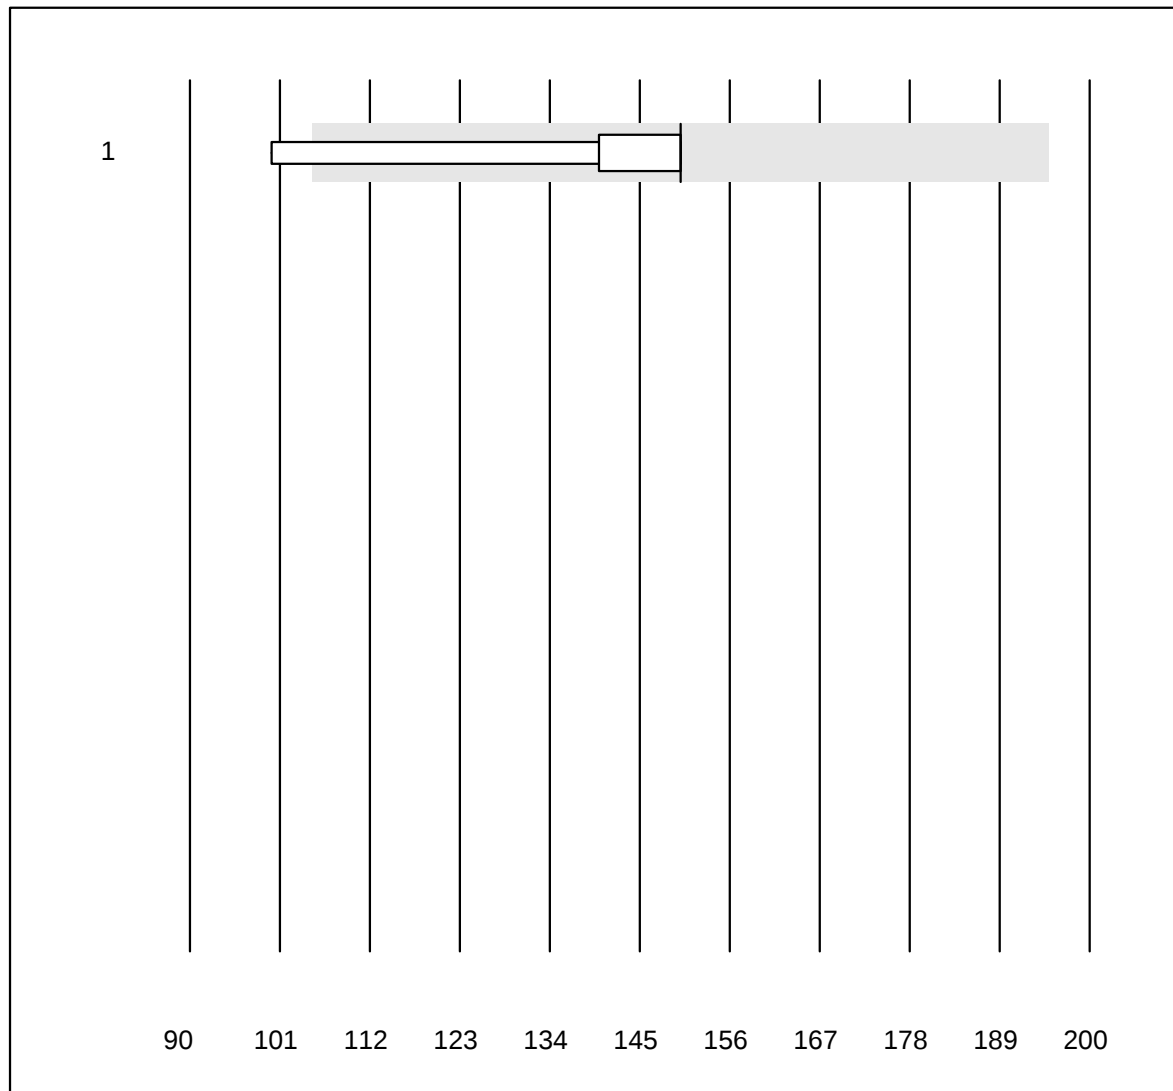


Tolérance MQ : 30 %

Vitesse de sédimentation 2h (mm/2h)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	BD Seditainer	7	85.7	14.3	0.0	150	13.0	e*

CRP

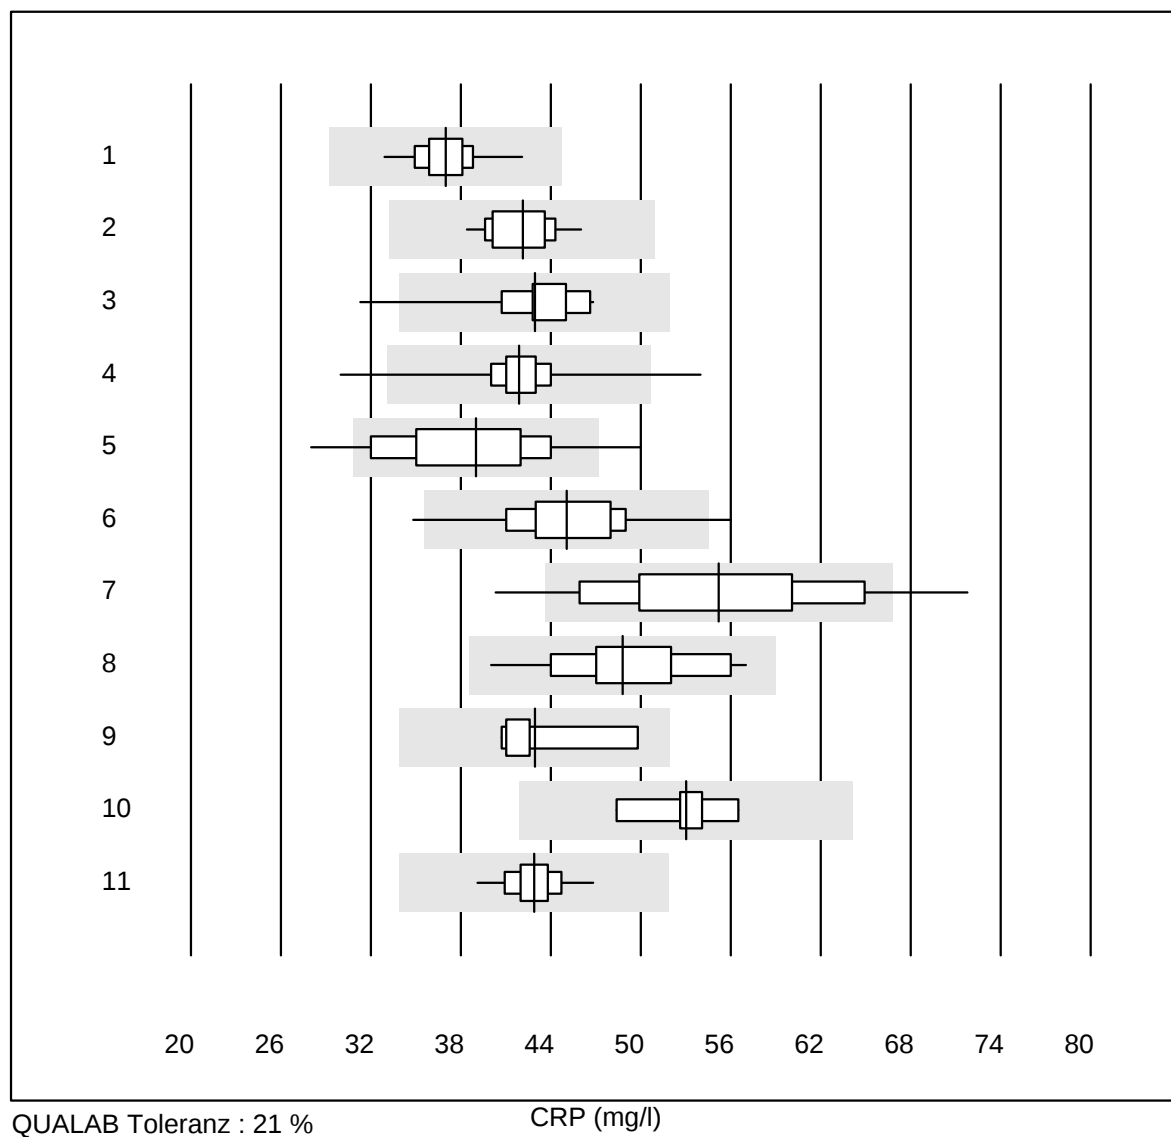

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas b101	253	99.2	0.0	0.8	37.0	4.2	e
2	Cobas	22	100.0	0.0	0.0	42.1	5.0	e
3	Turbidimetrie	15	80.0	6.7	13.3	43.0	9.1	e
4	Afinion	1290	99.0	0.5	0.5	41.9	4.8	e
5	NycoCard SingleTest-	126	84.9	4.0	11.1	39.0	11.8	e
6	Quick Read go	103	98.1	1.9	0.0	45.1	7.6	e
7	Eurolyser	95	75.8	7.4	16.8	55.2	12.8	e
8	Fuji Dri-Chem	14	100.0	0.0	0.0	48.8	9.5	e*
9	Autolyser/DiaSys	10	80.0	0.0	20.0	42.9	6.8	e
10	Piccolo	5	100.0	0.0	0.0	53.0	5.6	e
11	Celltac chemi	46	100.0	0.0	0.0	42.9	3.8	e

CRP

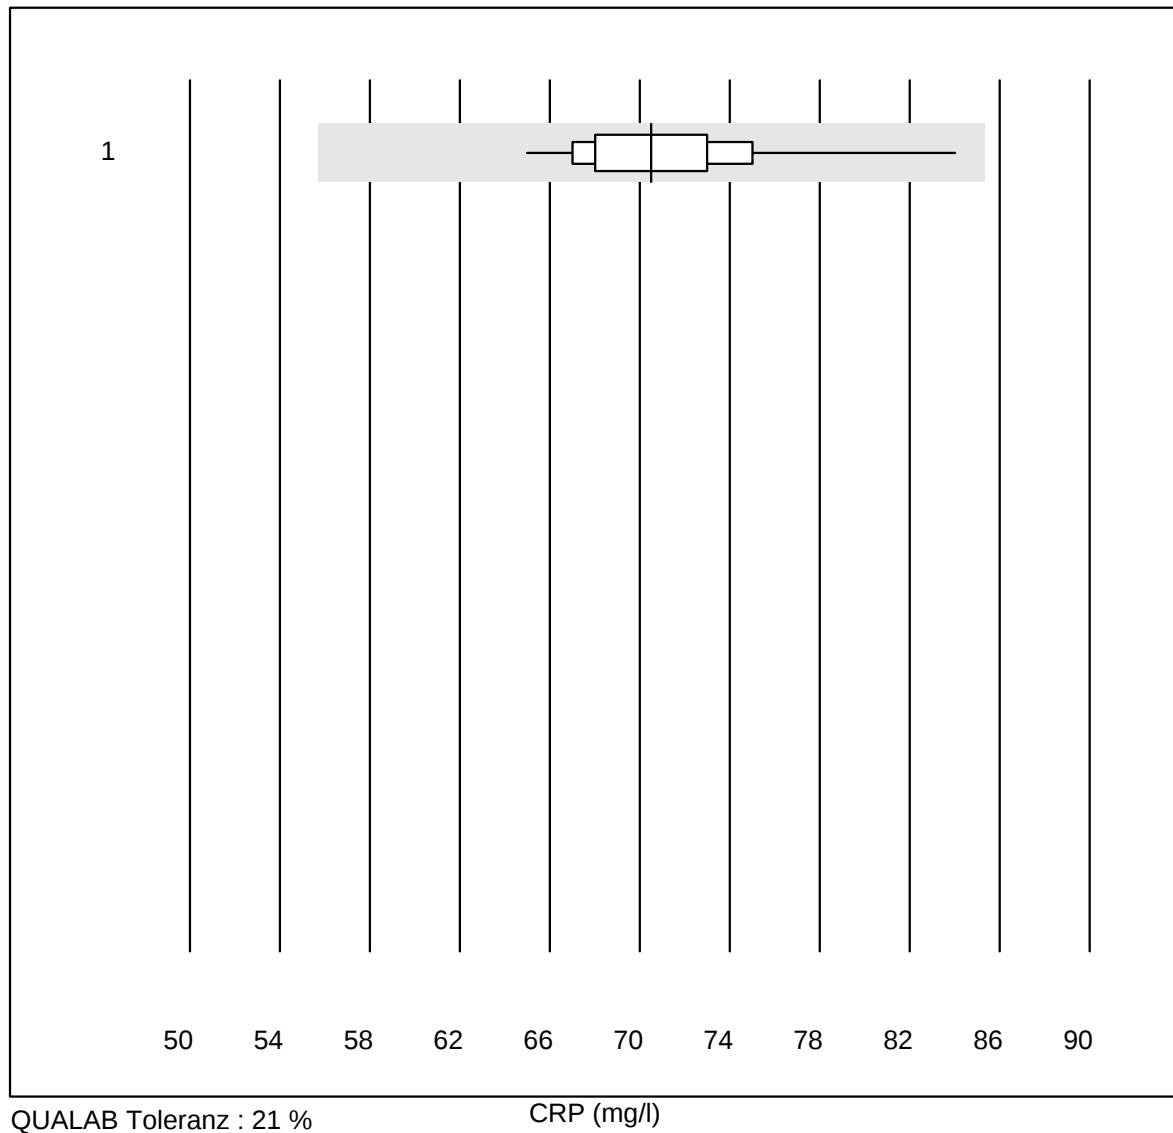


QUALAB Toleranz : 21 %

CRP (mg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	QuickRead (sang comp	39	94.9	0.0	5.1	70.5	5.5	e

CRP

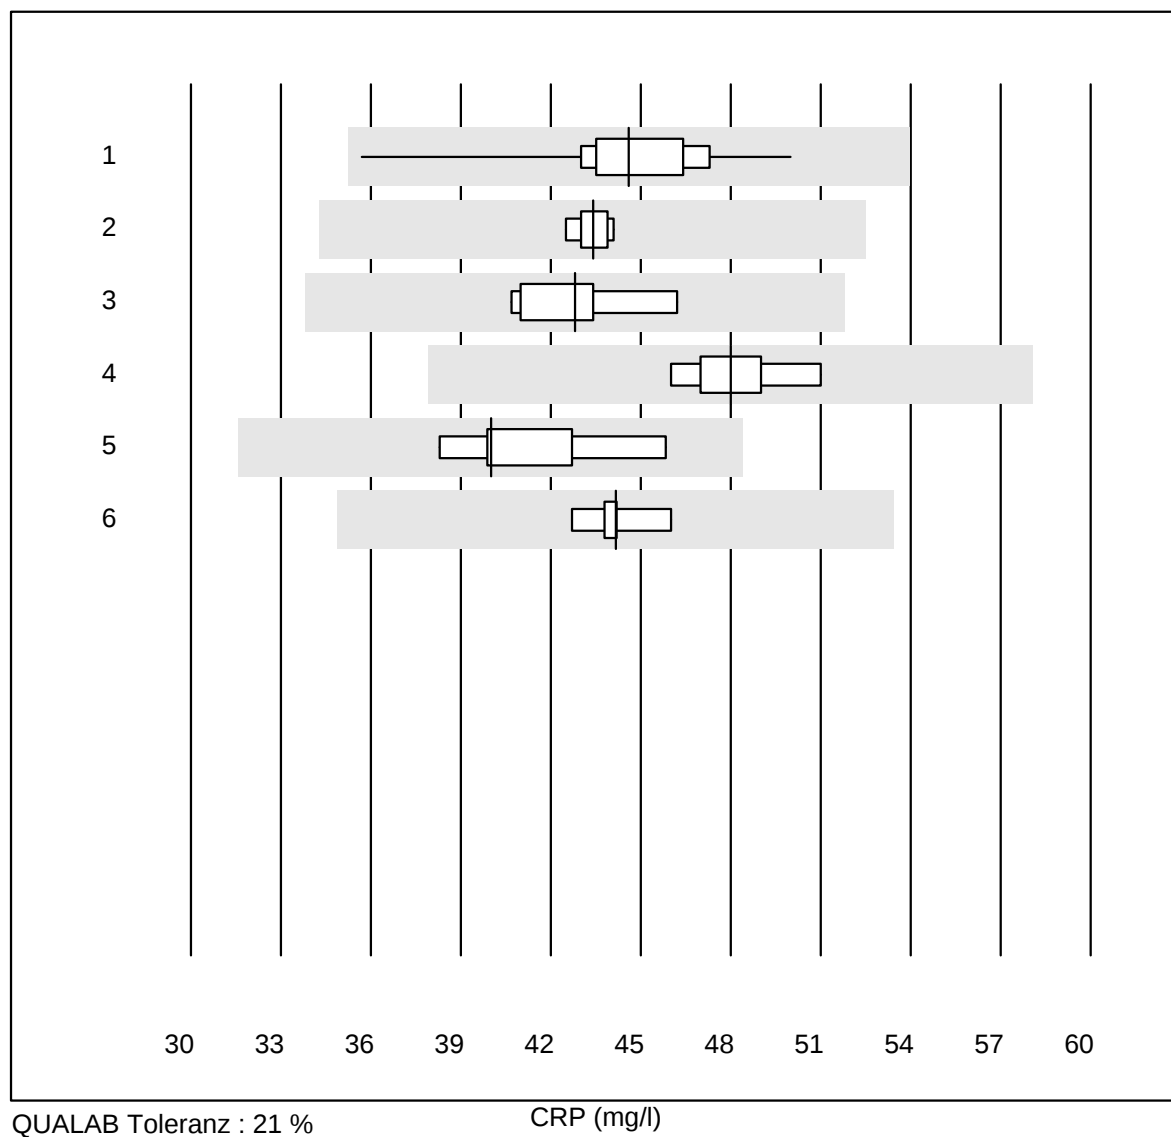


QUALAB Toleranz : 21 %

CRP (mg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Spinit	11	100.0	0.0	0.0	44.6	8.0	e
2	Architect	5	100.0	0.0	0.0	43.4	1.5	e
3	Beckman	6	100.0	0.0	0.0	42.8	4.7	e
4	AQT 90 FLEX	9	100.0	0.0	0.0	48.0	3.5	e
5	Spotchem D-Concept	7	100.0	0.0	0.0	40.0	6.1	e
6	Autres méthodes	5	100.0	0.0	0.0	44.2	2.7	e

IgG

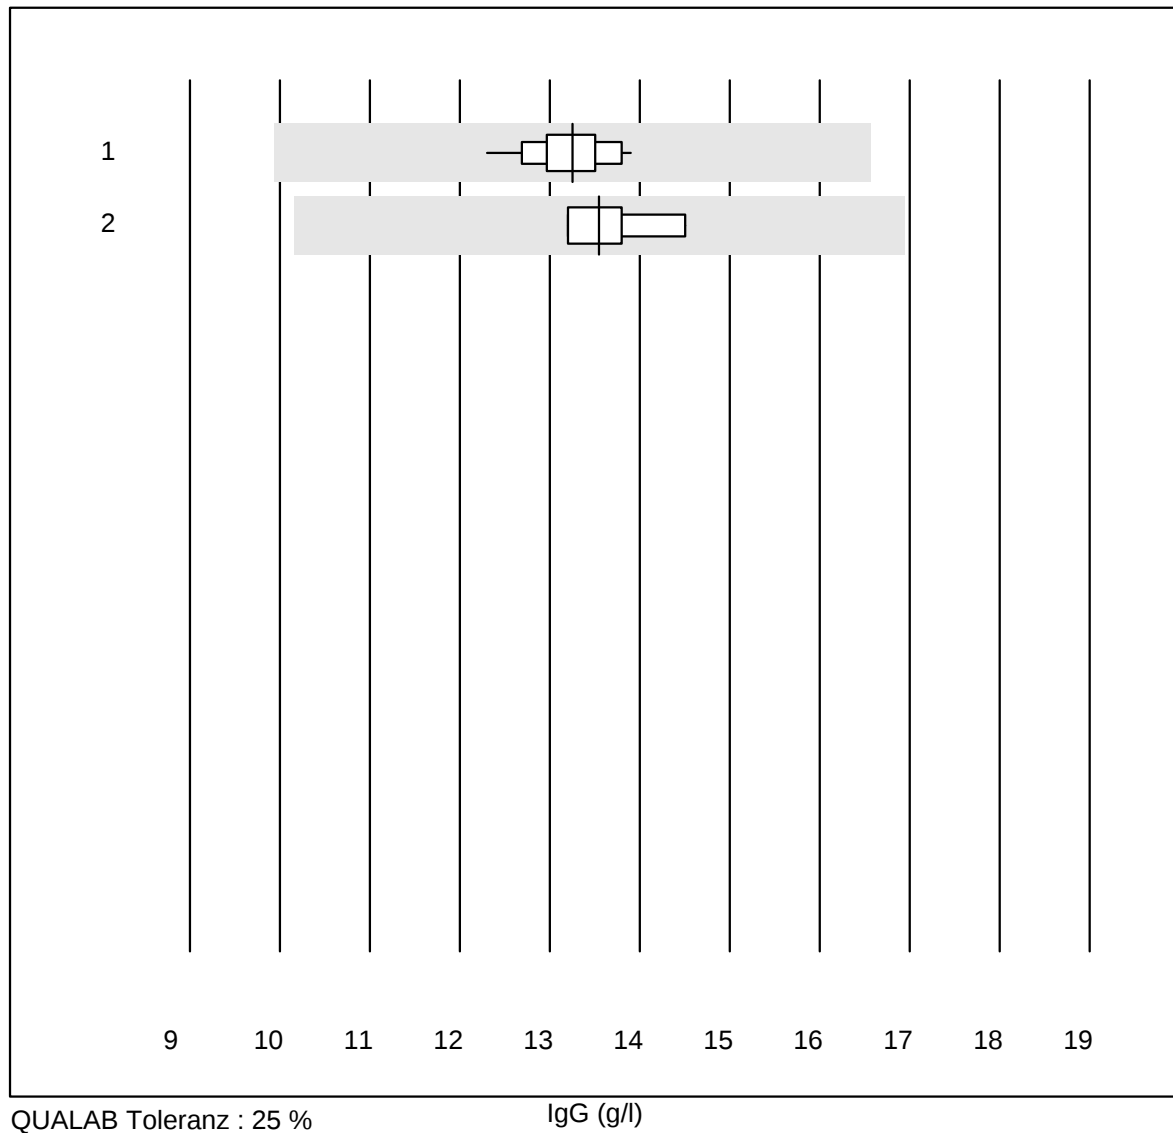


QUALAB Toleranz : 25 %

IgG (g/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Turbidimetrie	16	100.0	0.0	0.0	13.26	3.2	e
2	Nephelometrie	4	100.0	0.0	0.0	13.55	4.3	e

IgA

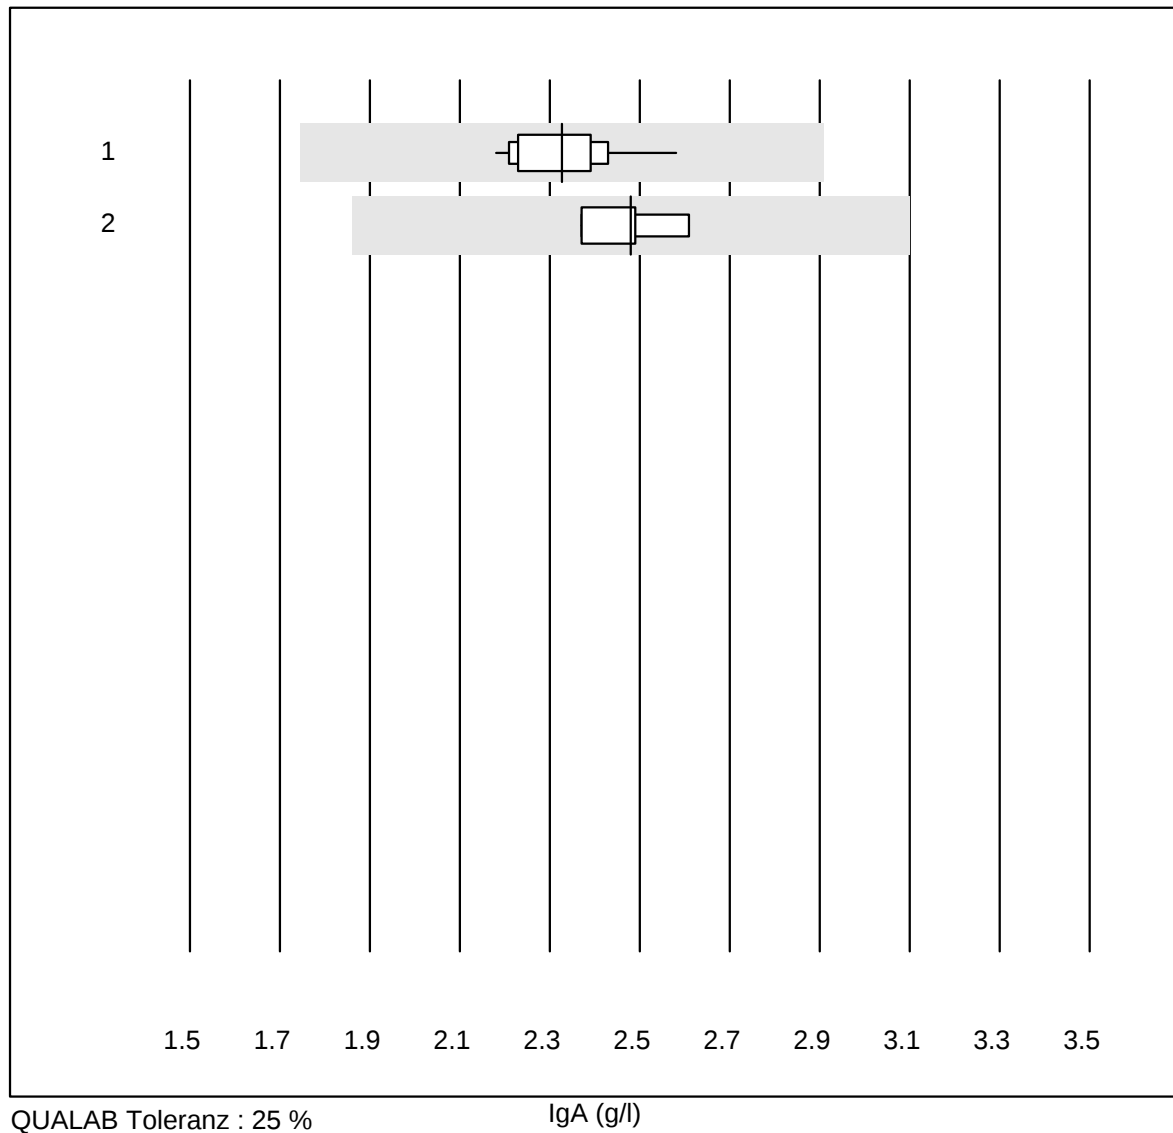


QUALAB Toleranz : 25 %

IgA (g/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Turbidimetrie	16	100.0	0.0	0.0	2.33	4.6	e
2	Nephelometrie	4	100.0	0.0	0.0	2.48	4.0	e

IgM

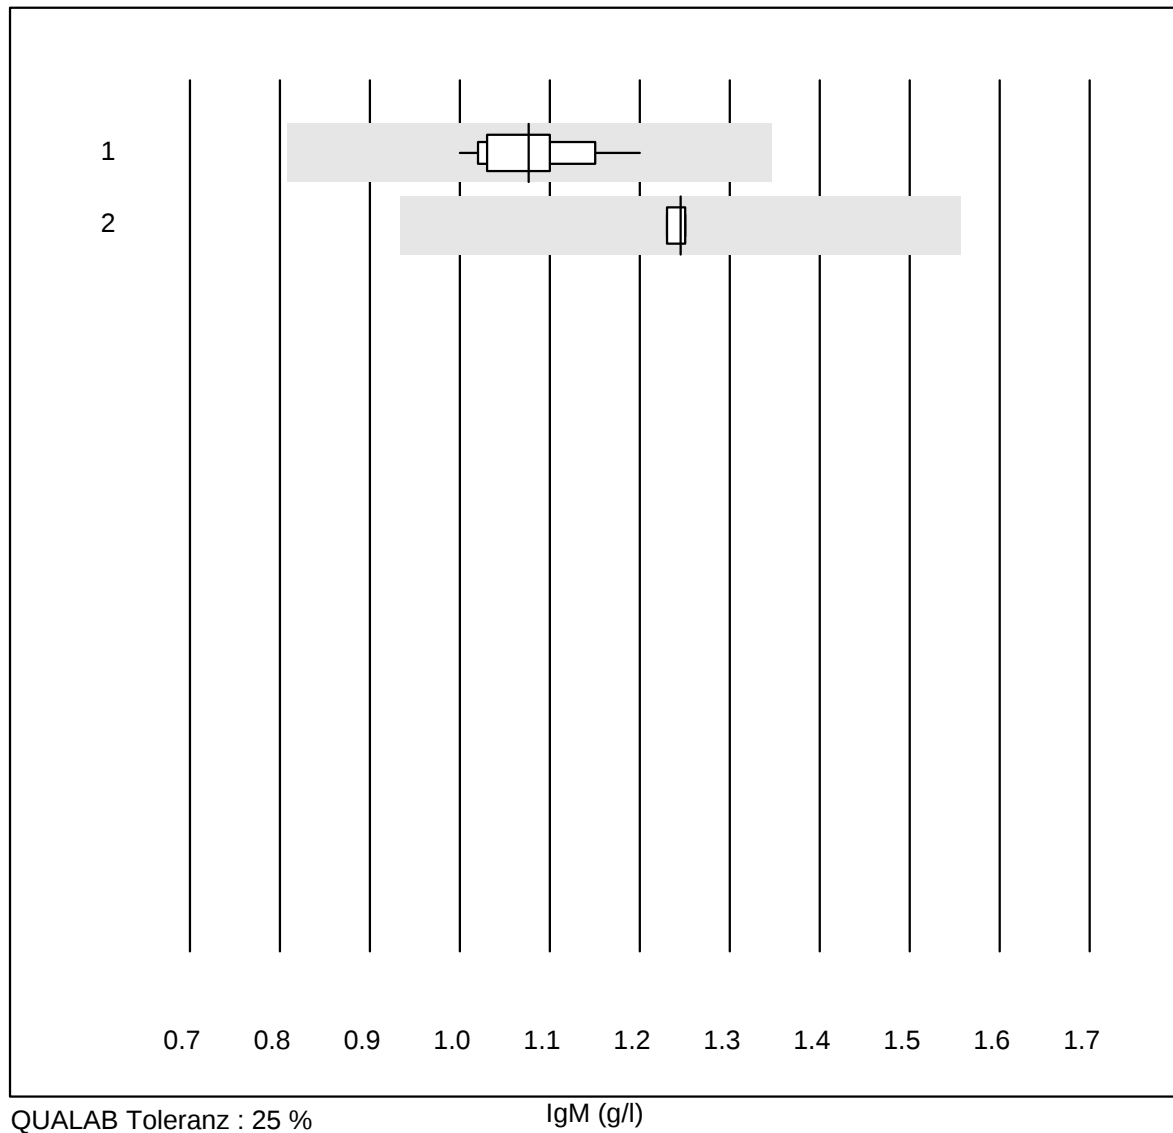


QUALAB Toleranz : 25 %

IgM (g/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Turbidimetrie	15	100.0	0.0	0.0	1.08	4.9	e
2	Nephelometrie	4	100.0	0.0	0.0	1.25	0.8	e

IgE

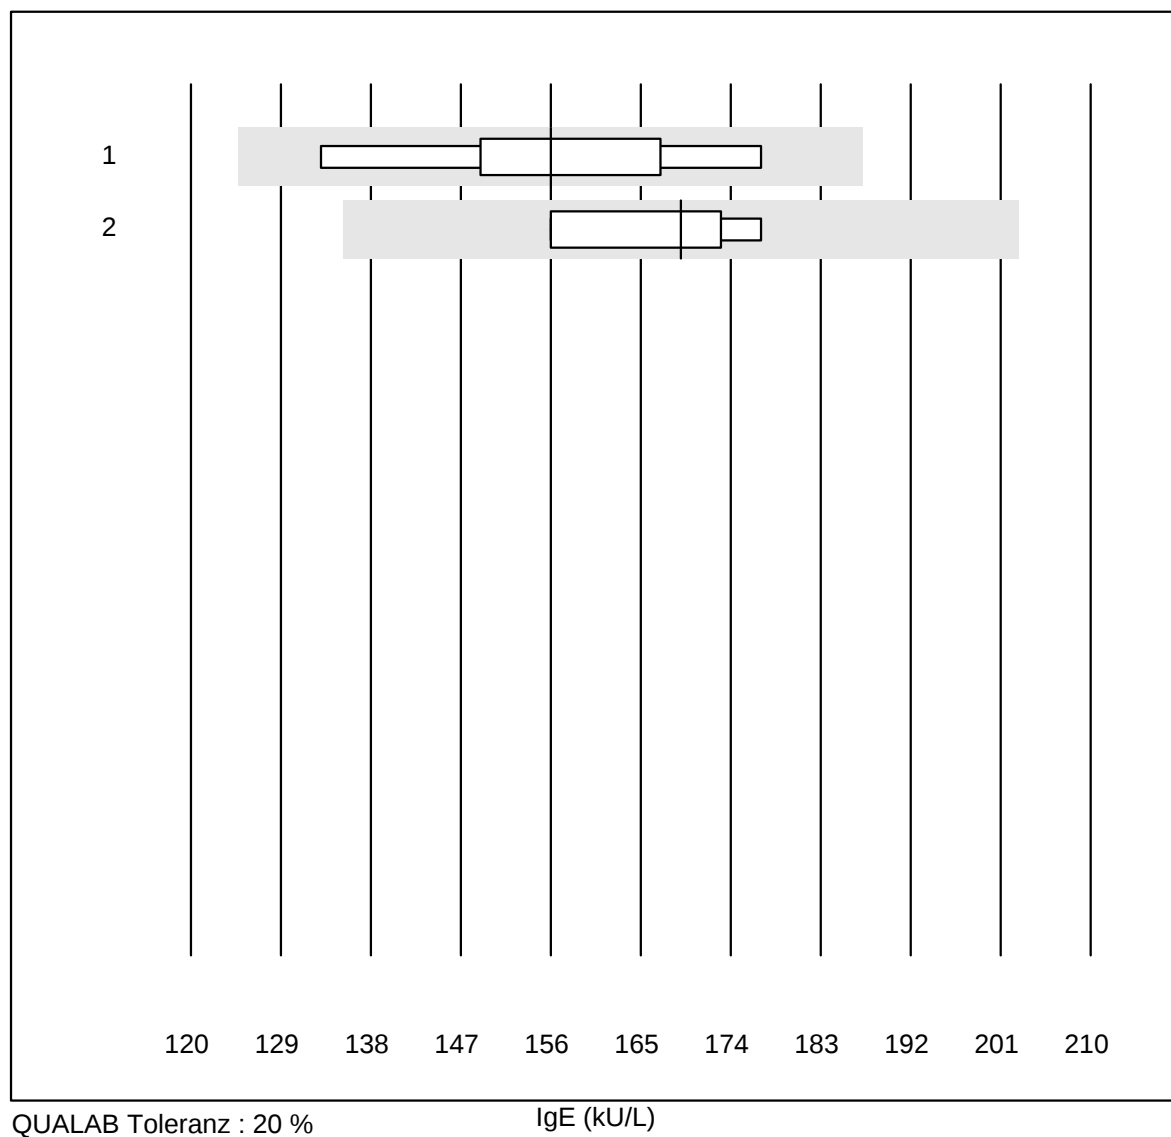


QUALAB Toleranz : 20 %

IgE (kU/L)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	156	9.7	e*
2	Cobas	4	100.0	0.0	0.0	169	5.5	e*

Alpha-1-Antitrypsine

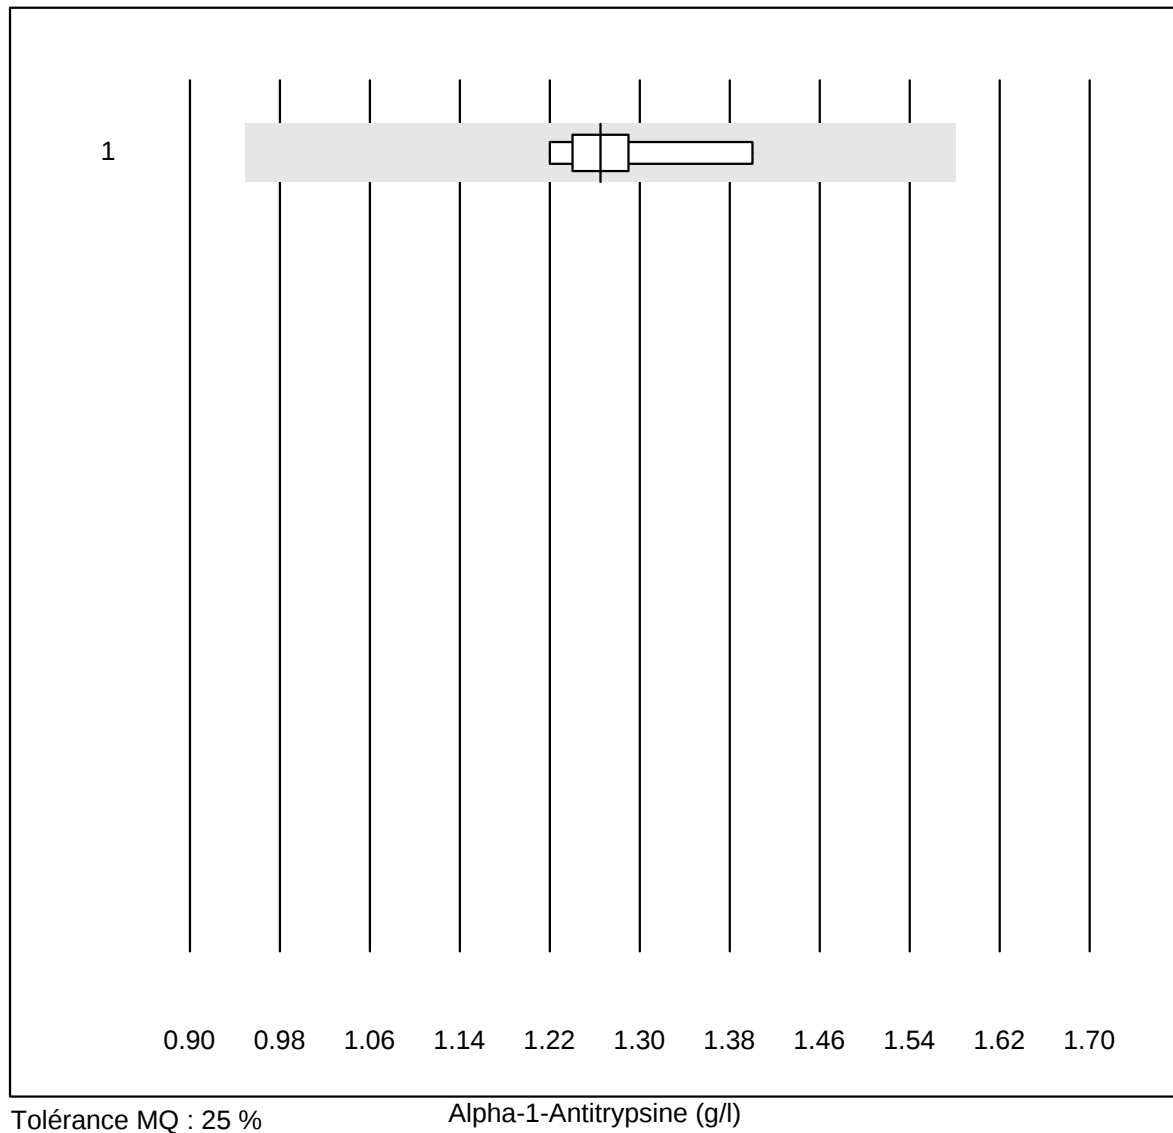

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	8	100.0	0.0	0.0	1.27	5.4	e

Anti-Streptolysine-Anticorps

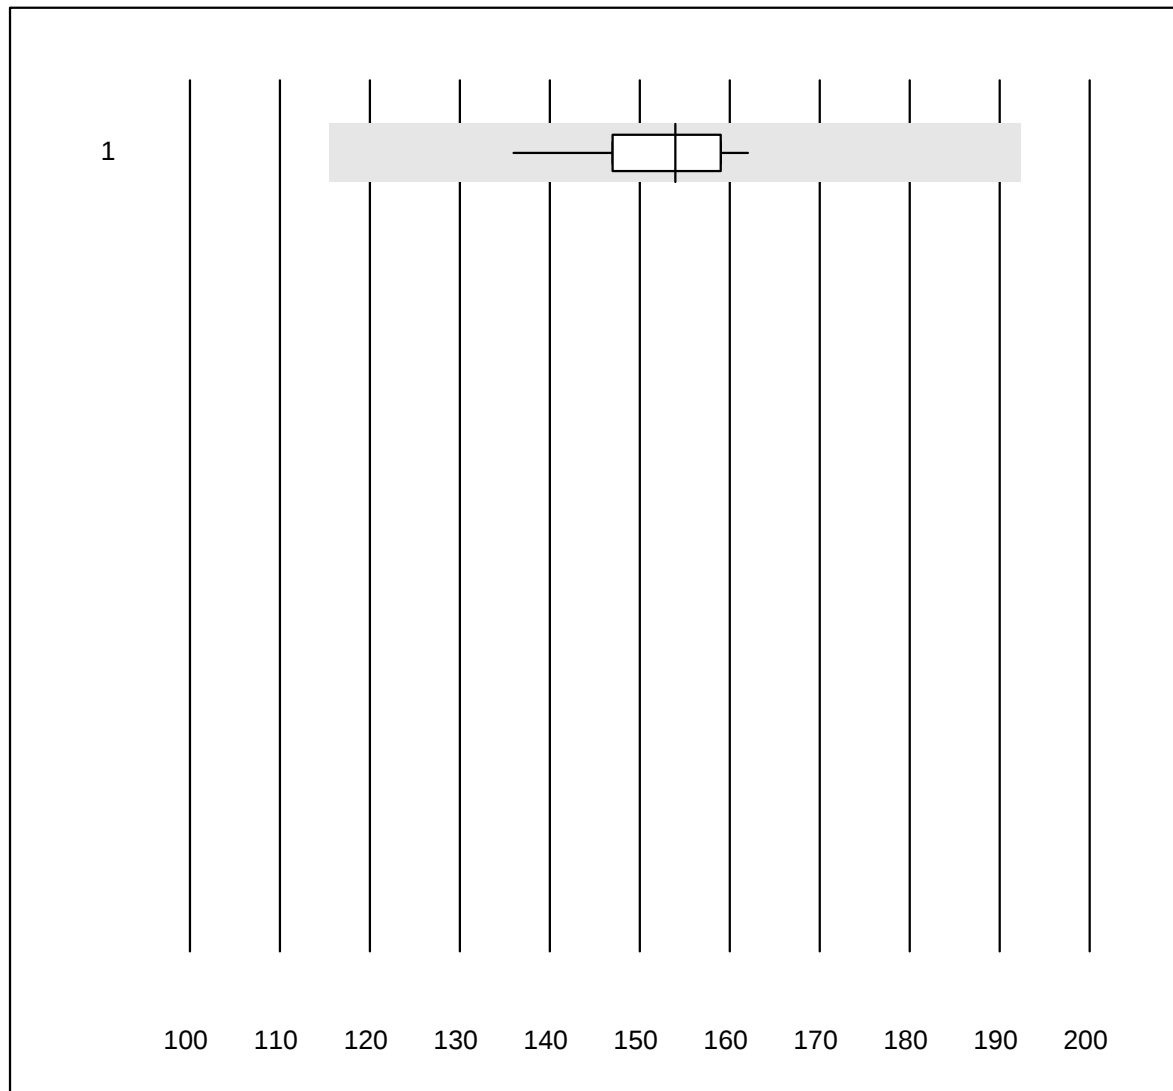


Tolérance MQ : 25 %

Anti-Streptolysine-Anticorps (kIU/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	11	100.0	0.0	0.0	154	5.0	e

Complément C3

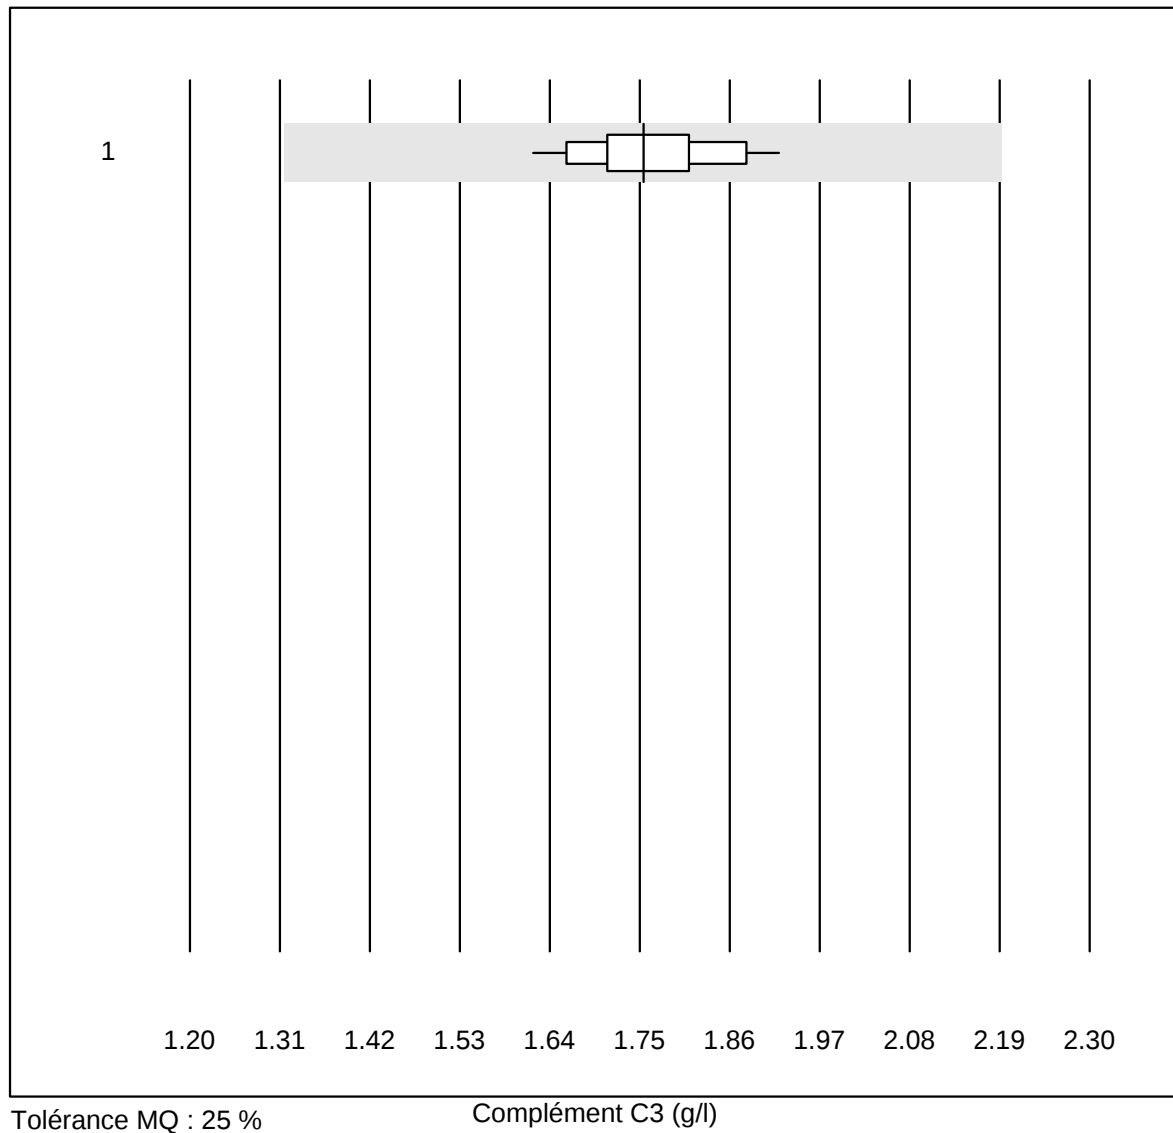


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	14	100.0	0.0	0.0	1.75	4.6	e

Complément C4

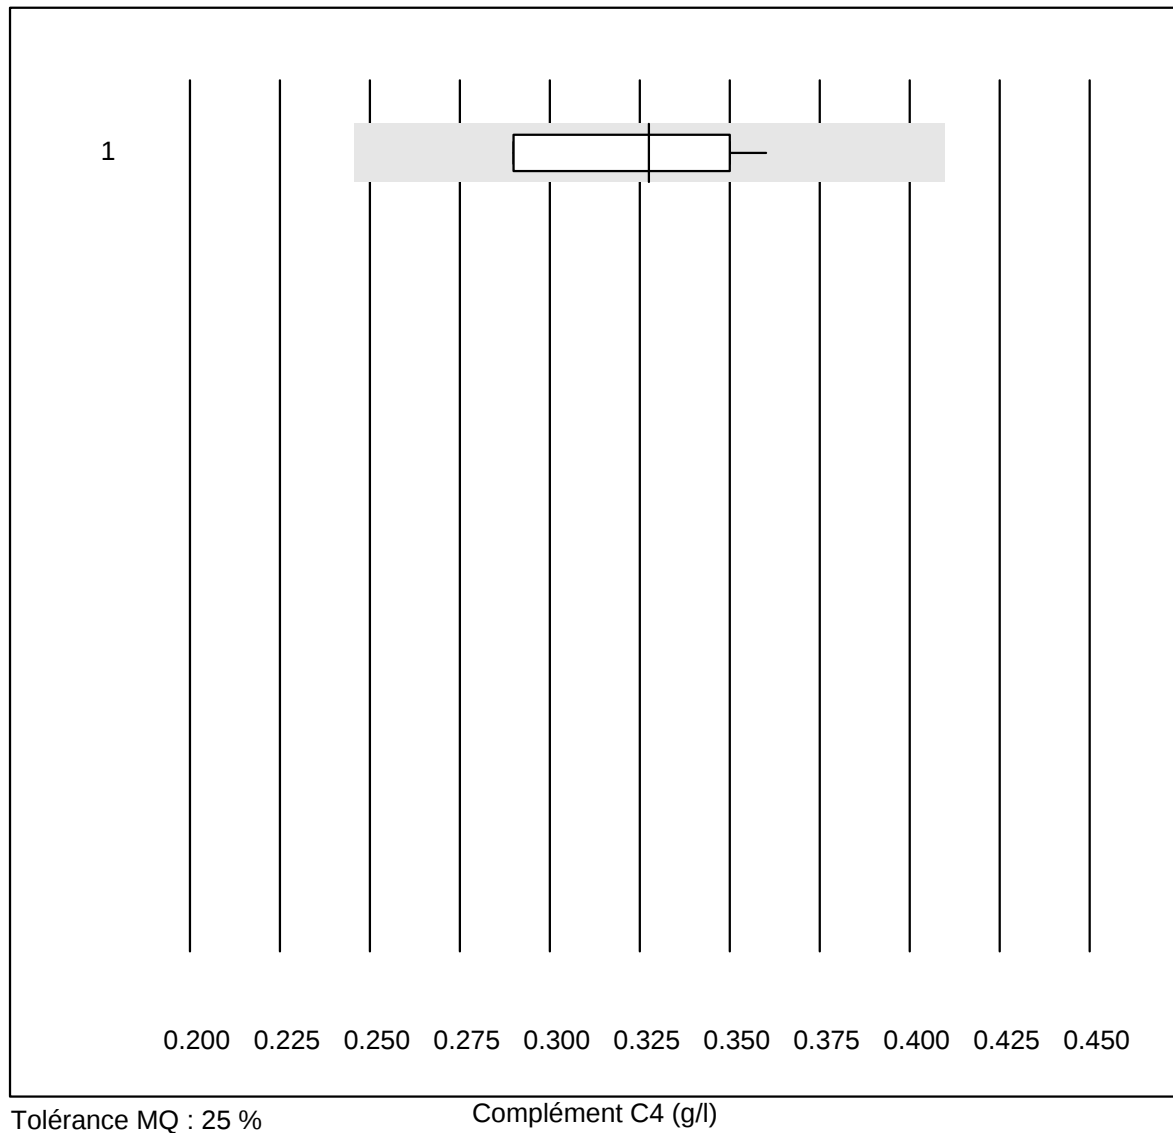


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	13	100.0	0.0	0.0	0.33	9.1	e

Haptoglobine

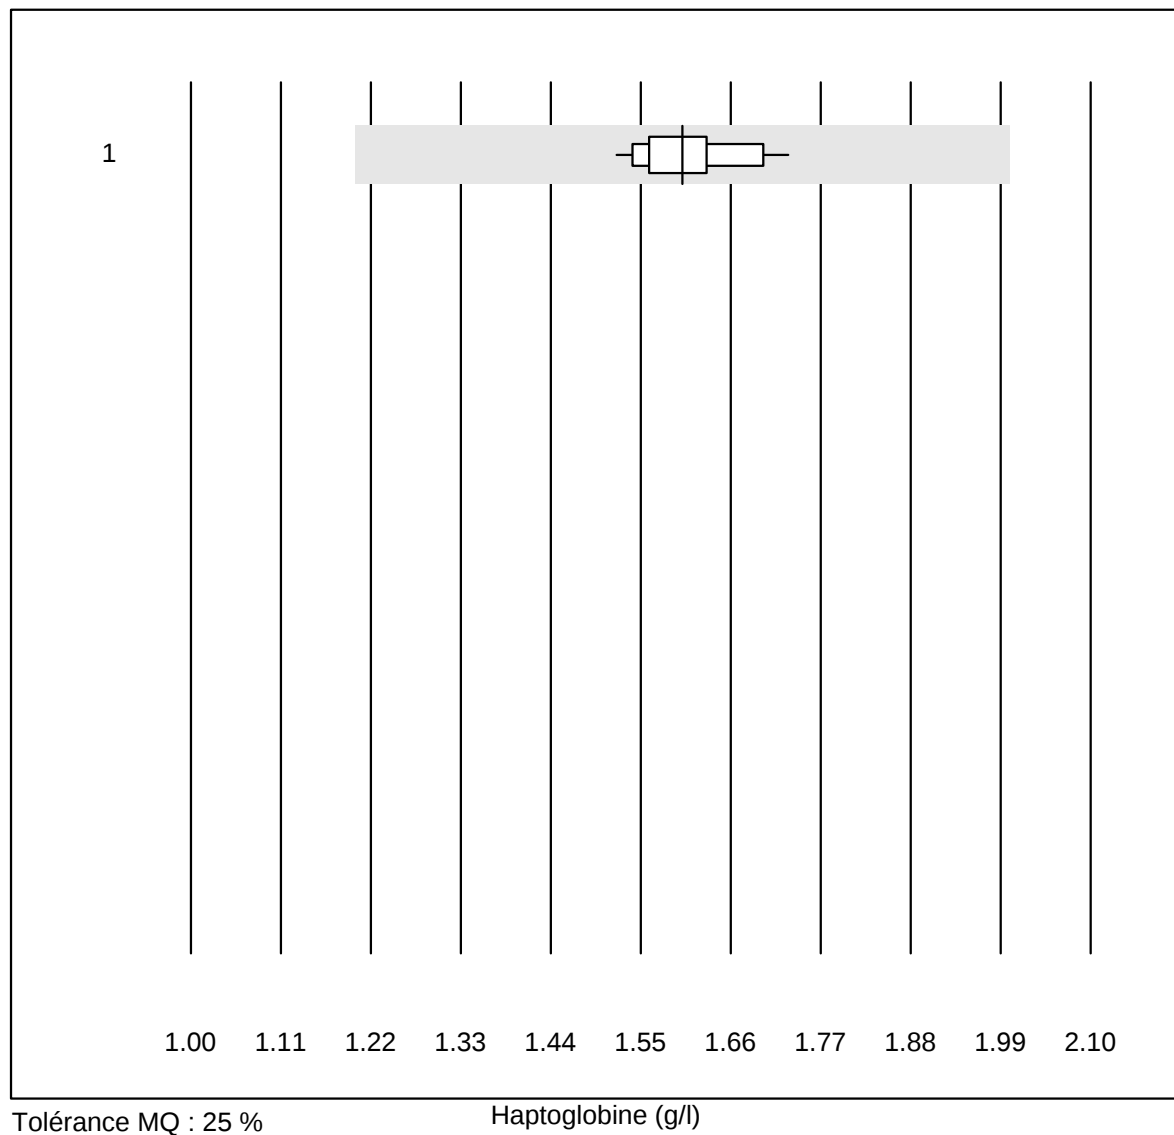


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	18	100.0	0.0	0.0	1.60	3.3	e

Transferrine

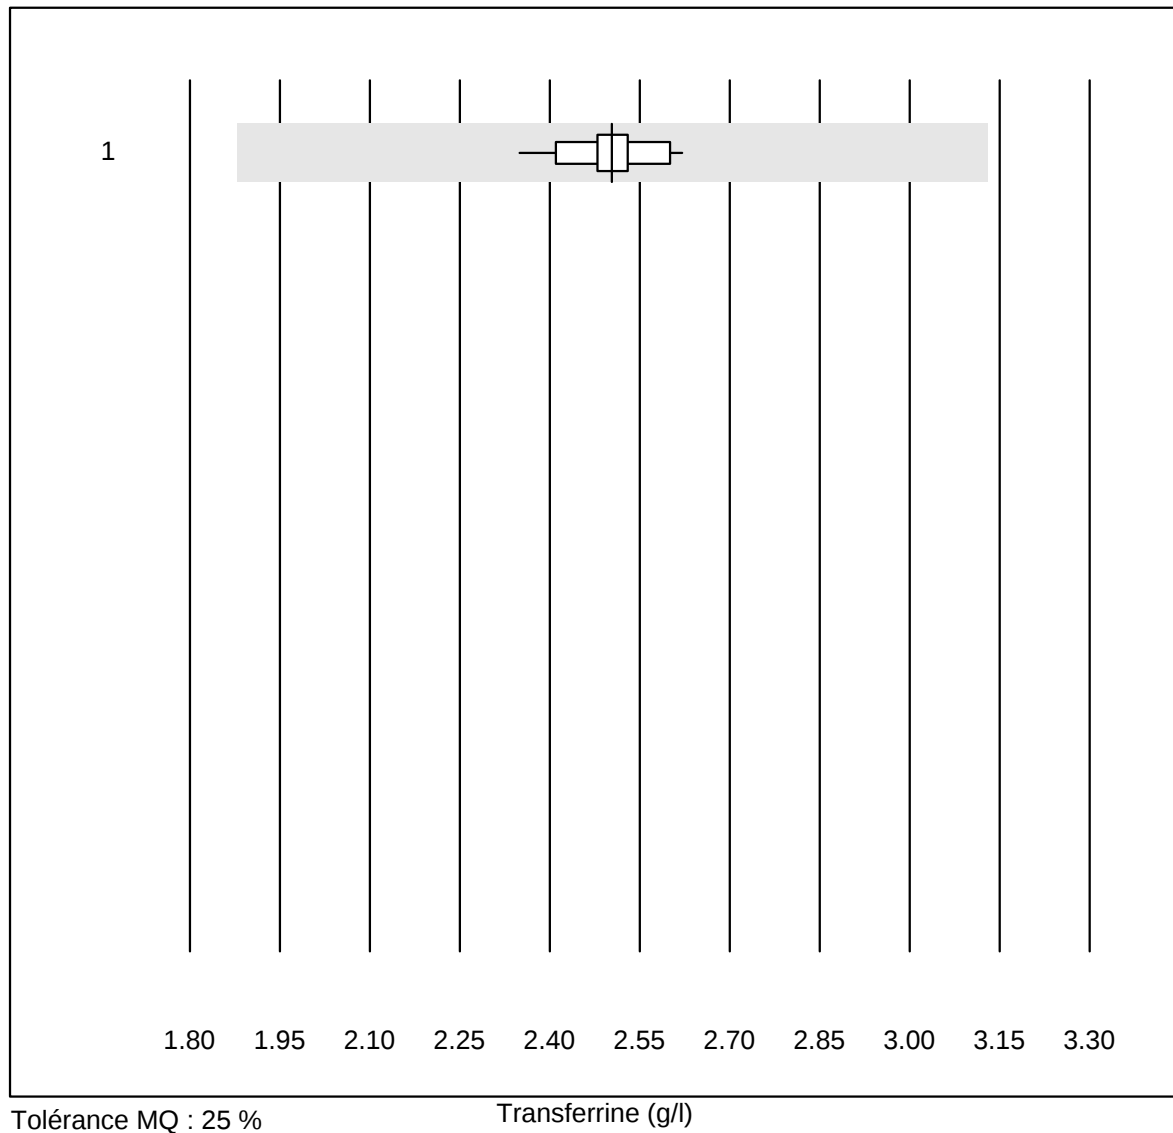


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	25	100.0	0.0	0.0	2.50	2.5	e

Bêta-2 microglobuline

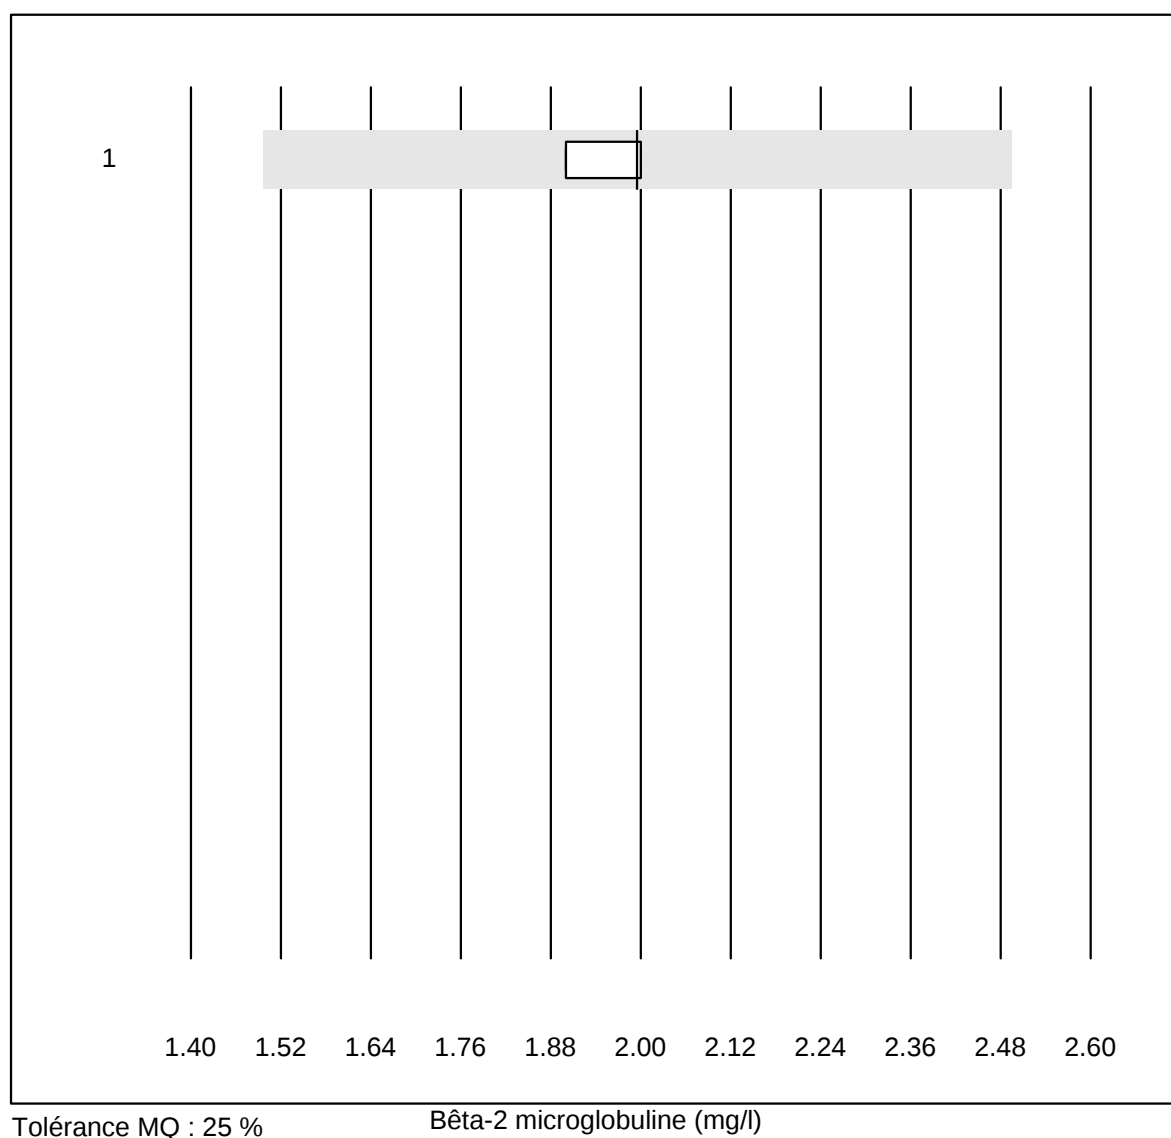


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	2.00	2.5	e

Facteur rhumatoïde

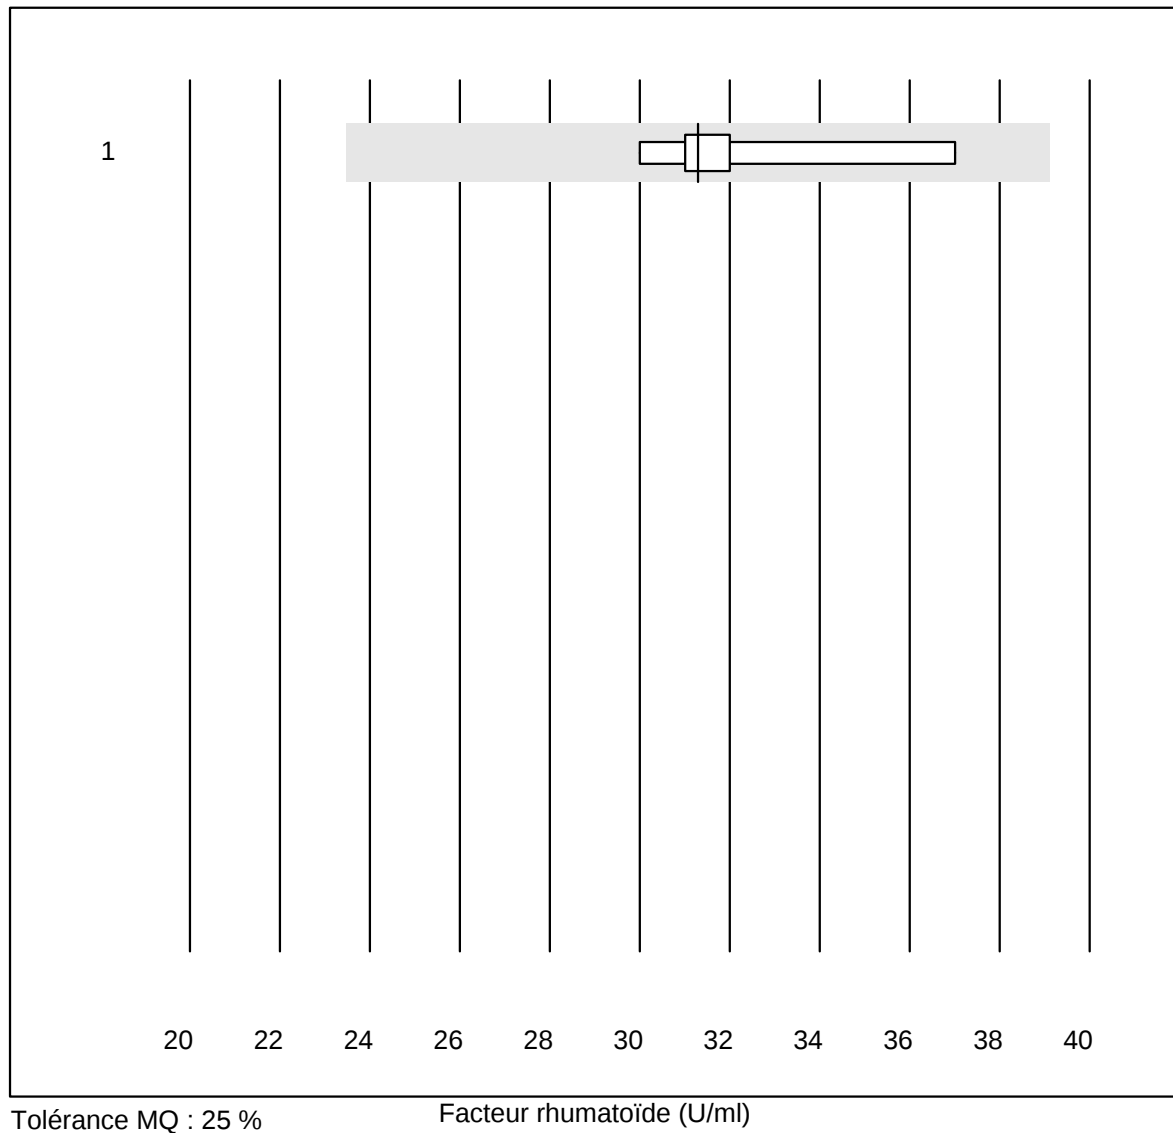


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	31.3	8.5	e*

Céruloplasmine

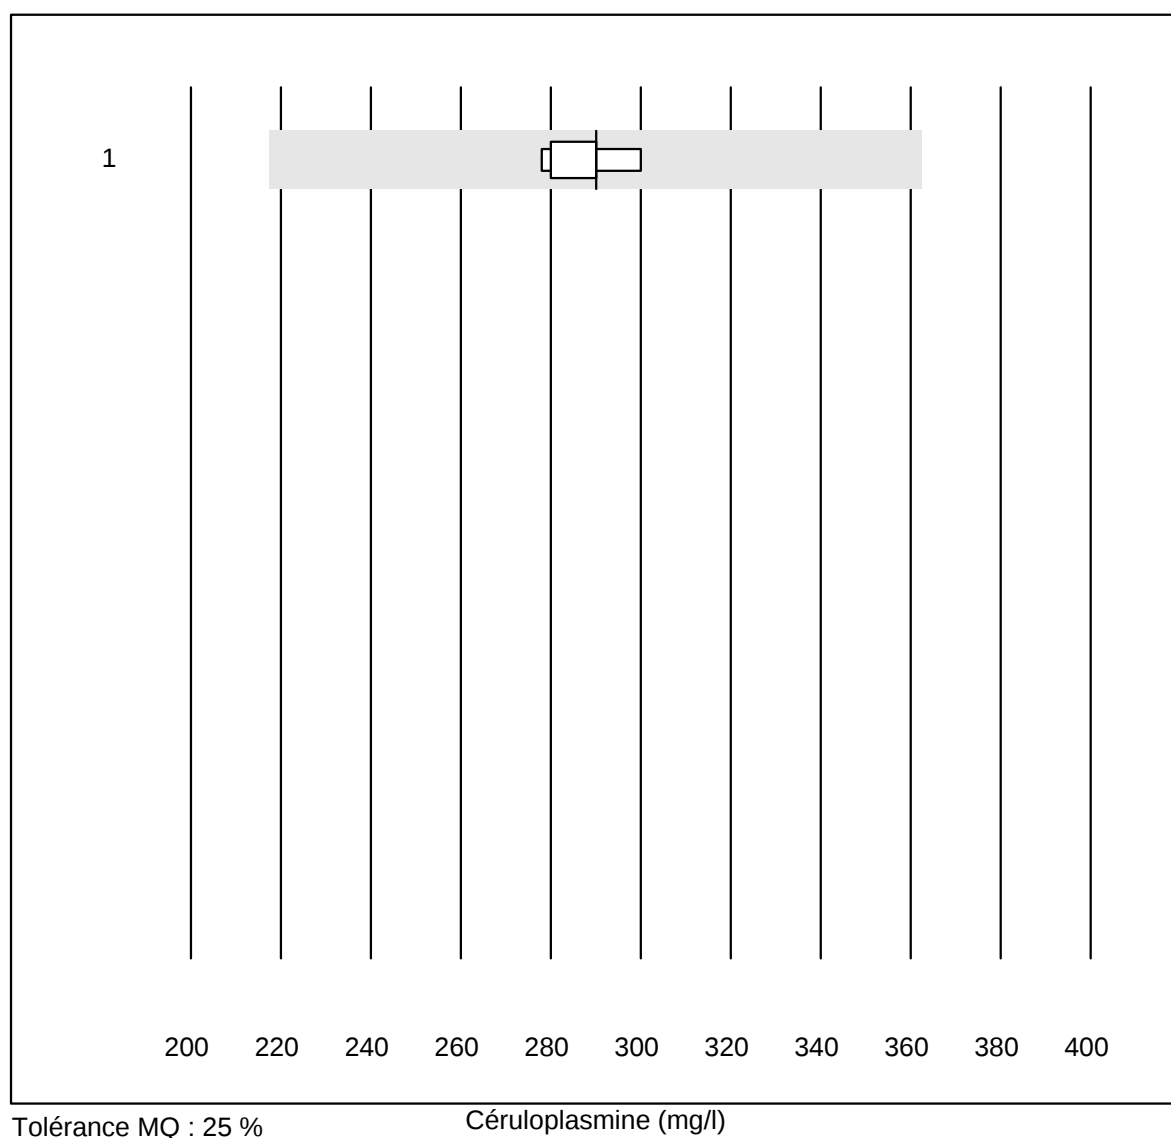


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	290.00	3.1	e

Pré-albumine

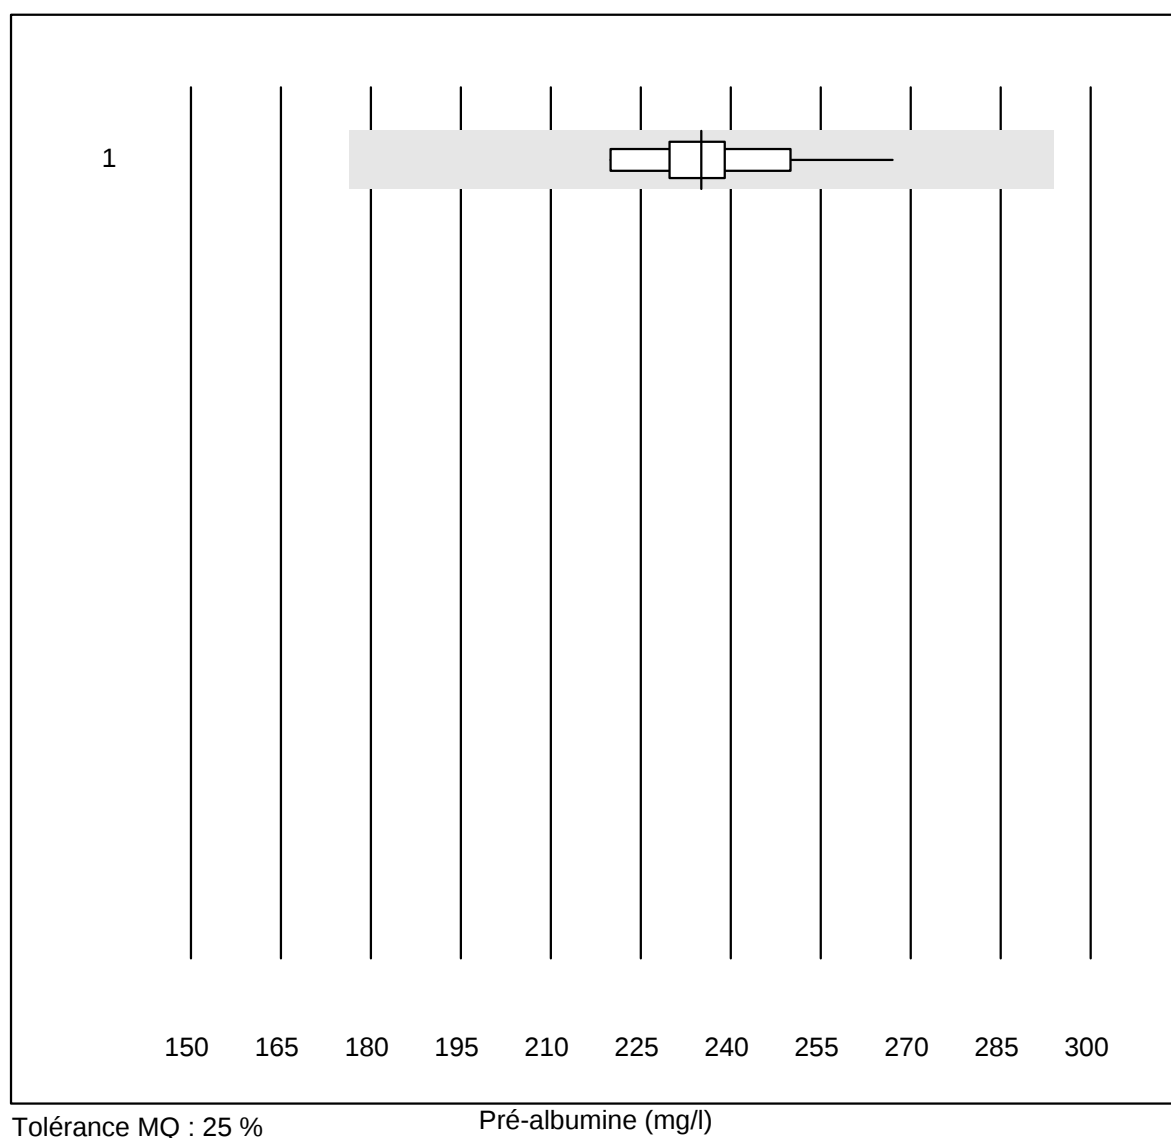


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	16	100.0	0.0	0.0	235.1	5.1	e

Récepteur soluble de la transferrine

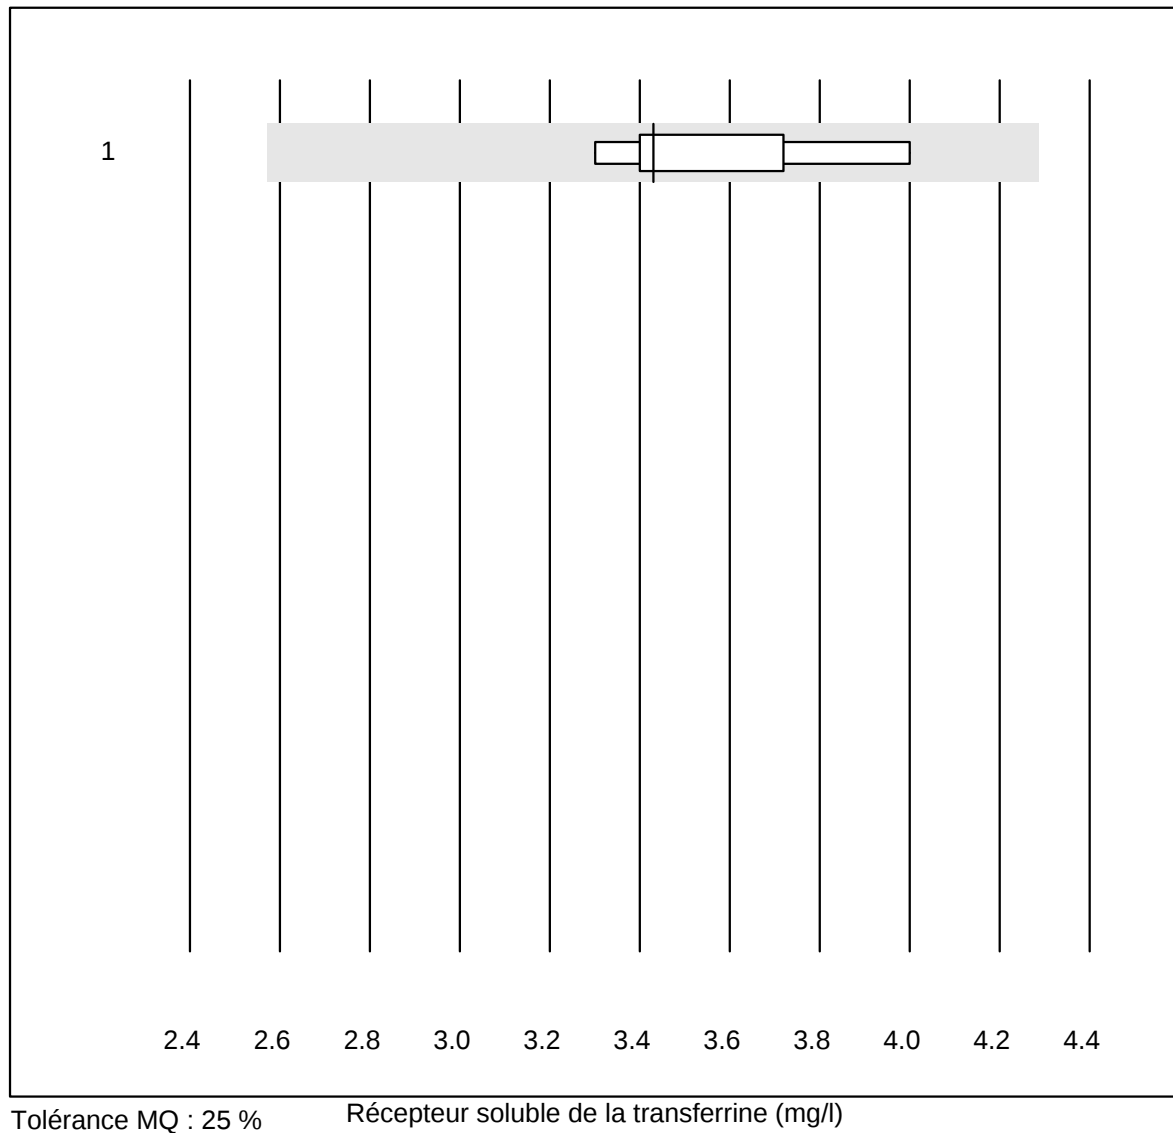

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	3.4	6.9	e

CRP HS

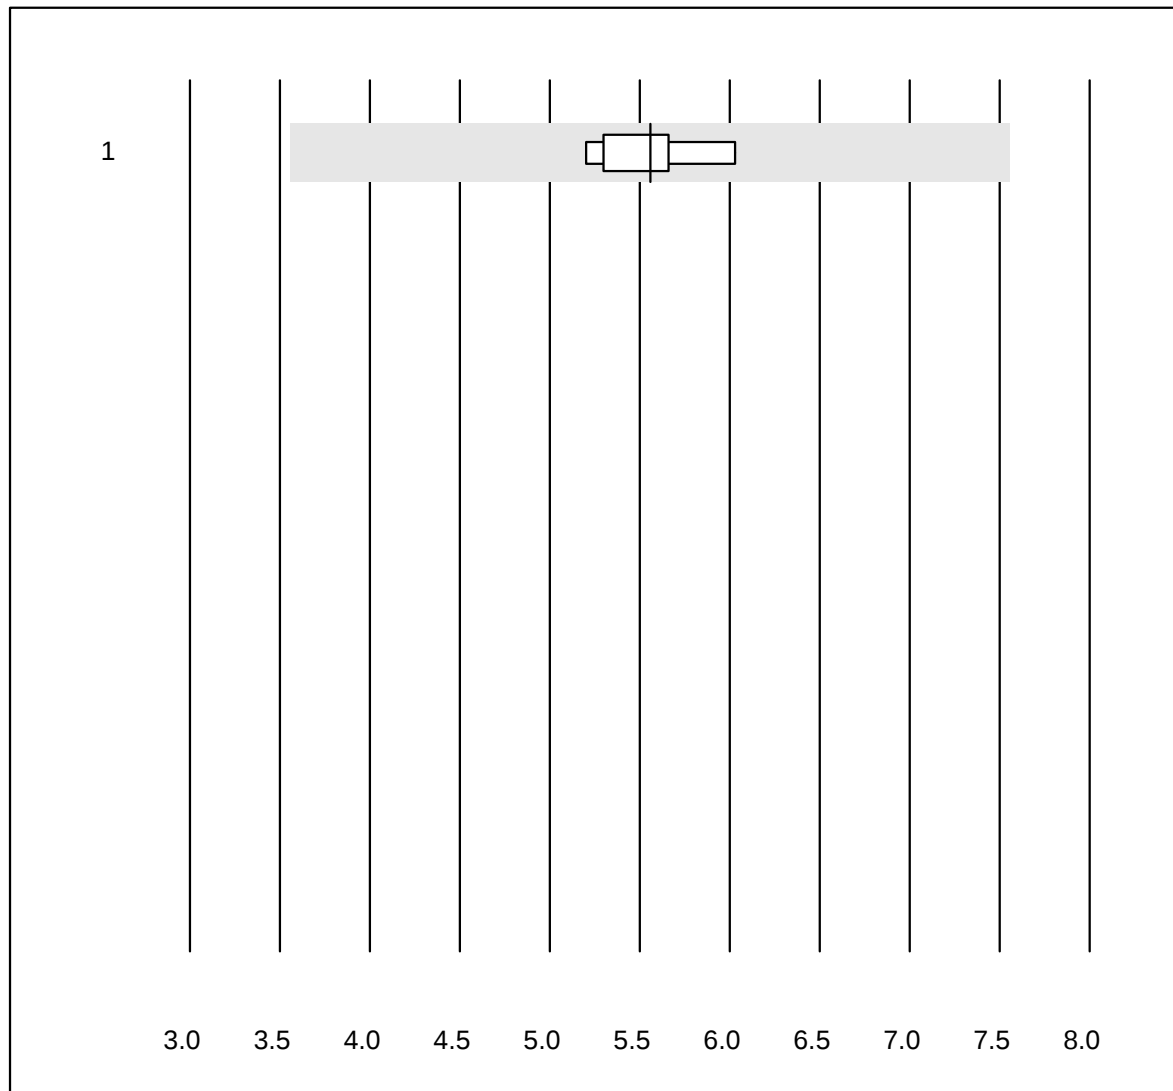


QUALAB Toleranz : 21 %
(< 10.00: +/- 2.00 mg/l)

CRP HS (mg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Turbidimetrie	6	100.0	0.0	0.0	5.56	5.3	e


CRP

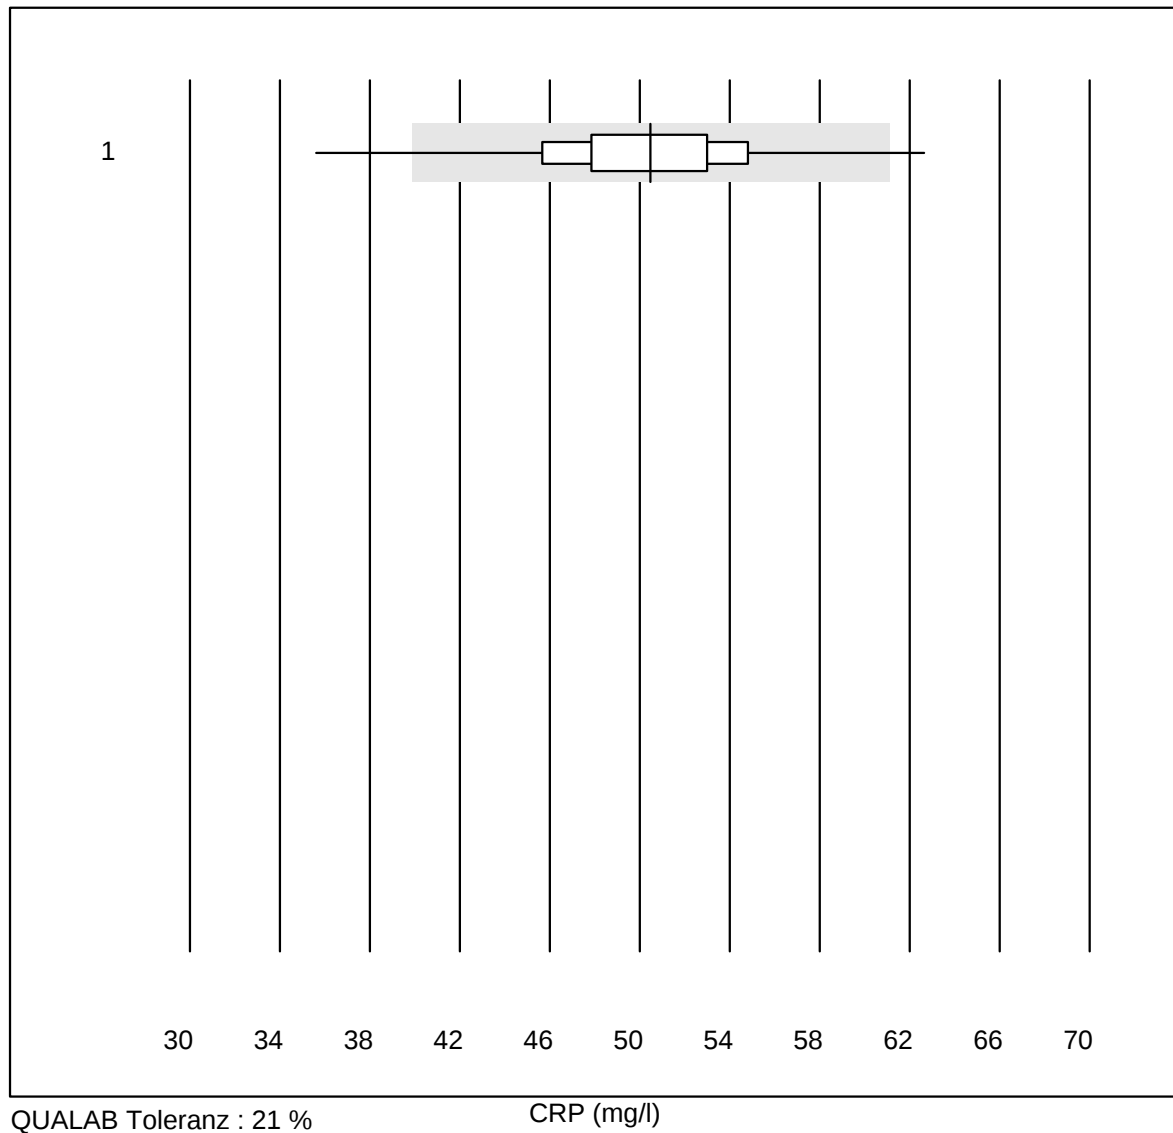

QUALAB Toleranz : 21 %


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 AFIAS	120	93.4	3.3	3.3	50.5	8.8	e

Albumine

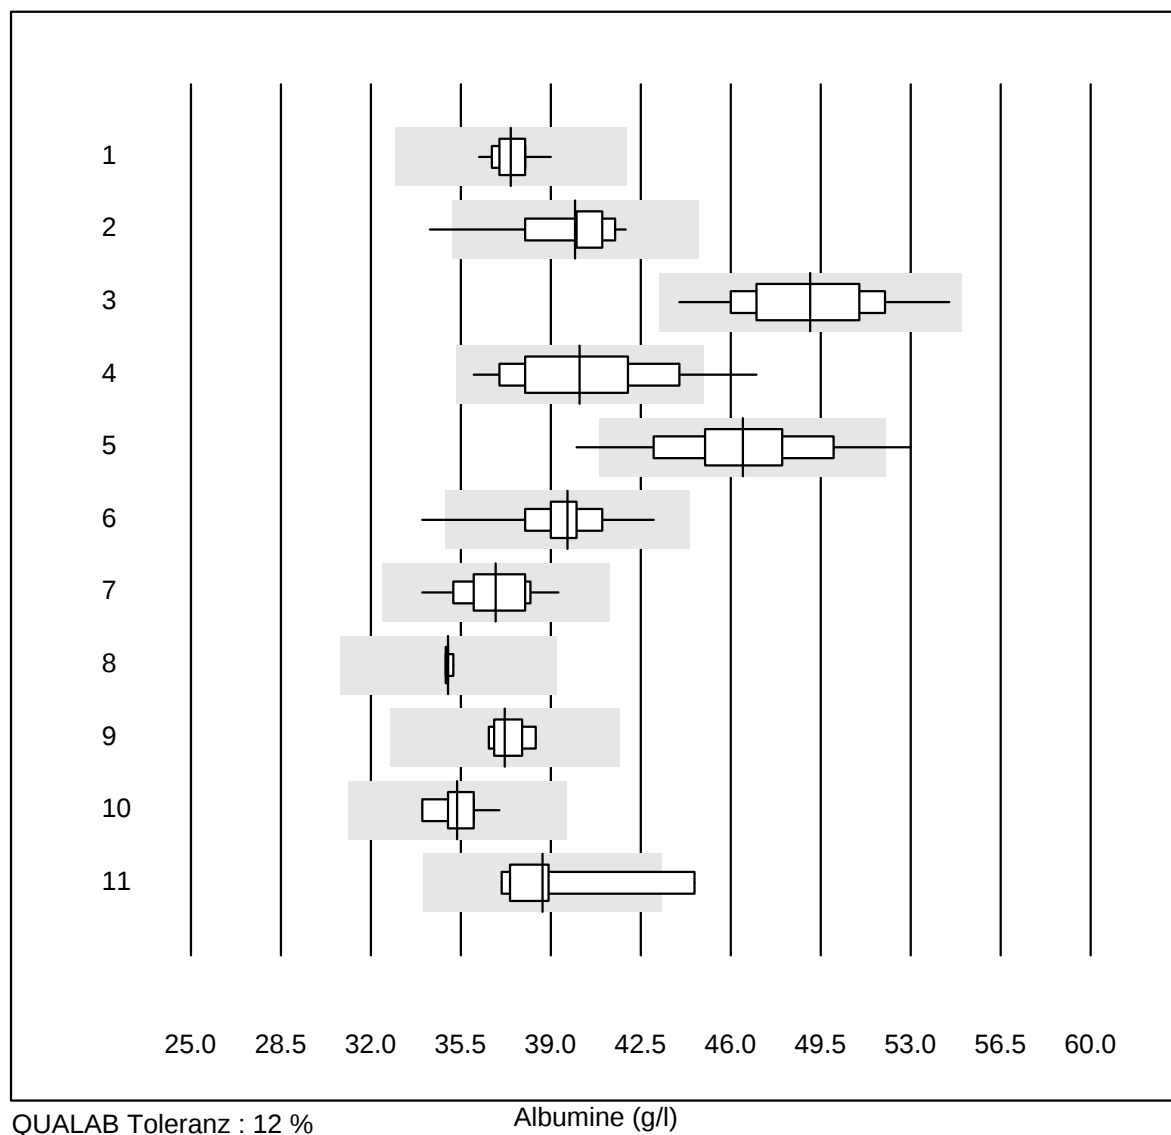


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	11	100.0	0.0	0.0	37	2.2	e
2	Cobas	22	95.5	4.5	0.0	40	4.4	e
3	Fuji Dri-Chem	222	99.1	0.0	0.9	49	4.4	e
4	Spotchem/Ready	28	89.3	3.6	7.1	40	6.7	e
5	Spotchem D-Concept	164	97.6	1.8	0.6	46	5.4	e
6	Piccolo	52	98.1	1.9	0.0	40	3.4	e
7	Beckmann	11	100.0	0.0	0.0	37	4.0	e
8	Dimension	4	100.0	0.0	0.0	35	0.4	e
9	Abx Mira	5	100.0	0.0	0.0	37	2.0	e
10	Hitachi S40/M40	11	100.0	0.0	0.0	35	2.6	e
11	Autolyser/DiaSys	7	85.7	14.3	0.0	39	6.6	e*

Phosphatase alkaline

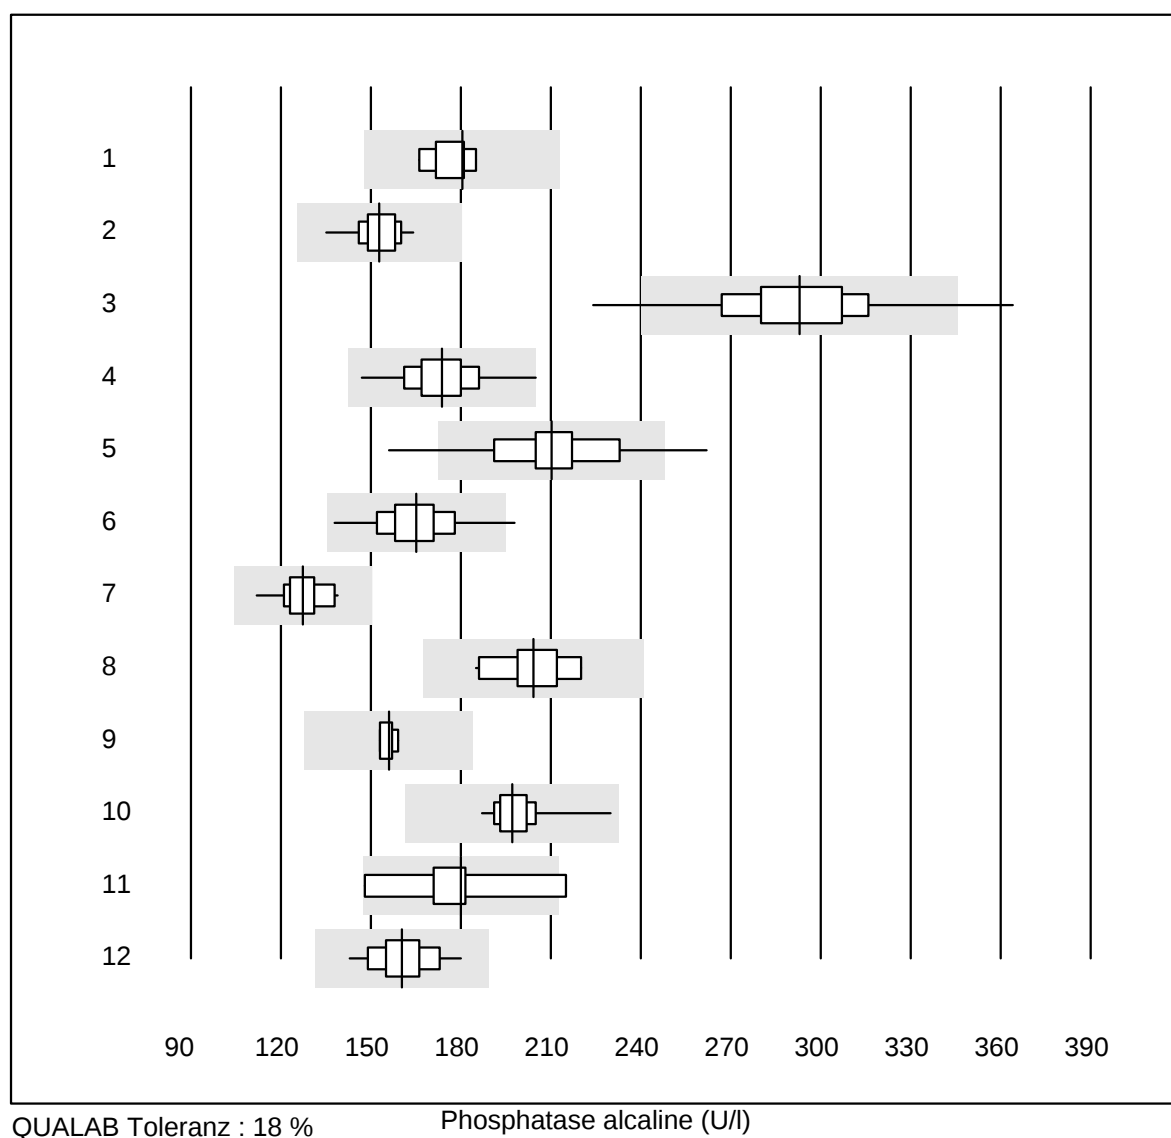


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	8	100.0	0.0	0.0	181	3.6	e
2 Cobas	23	100.0	0.0	0.0	153	4.3	e
3 Reflotron	453	96.9	2.2	0.9	293	7.1	e
4 Fuji Dri-Chem	819	98.9	0.1	1.0	174	5.7	e
5 Spotchem/Ready	53	92.5	7.5	0.0	210	8.7	e
6 Spotchem D-Concept	307	98.4	0.3	1.3	165	6.2	e
7 Hitachi S40/M40	16	100.0	0.0	0.0	127	5.3	e
8 Beckman	13	100.0	0.0	0.0	204	5.5	e
9 Dimension	4	100.0	0.0	0.0	156	1.7	e
10 Piccolo	44	97.7	0.0	2.3	197	3.8	e
11 Abx Mira	8	87.5	12.5	0.0	180	11.7	e*
12 Autolyser/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	160	5.8	e

Amylase

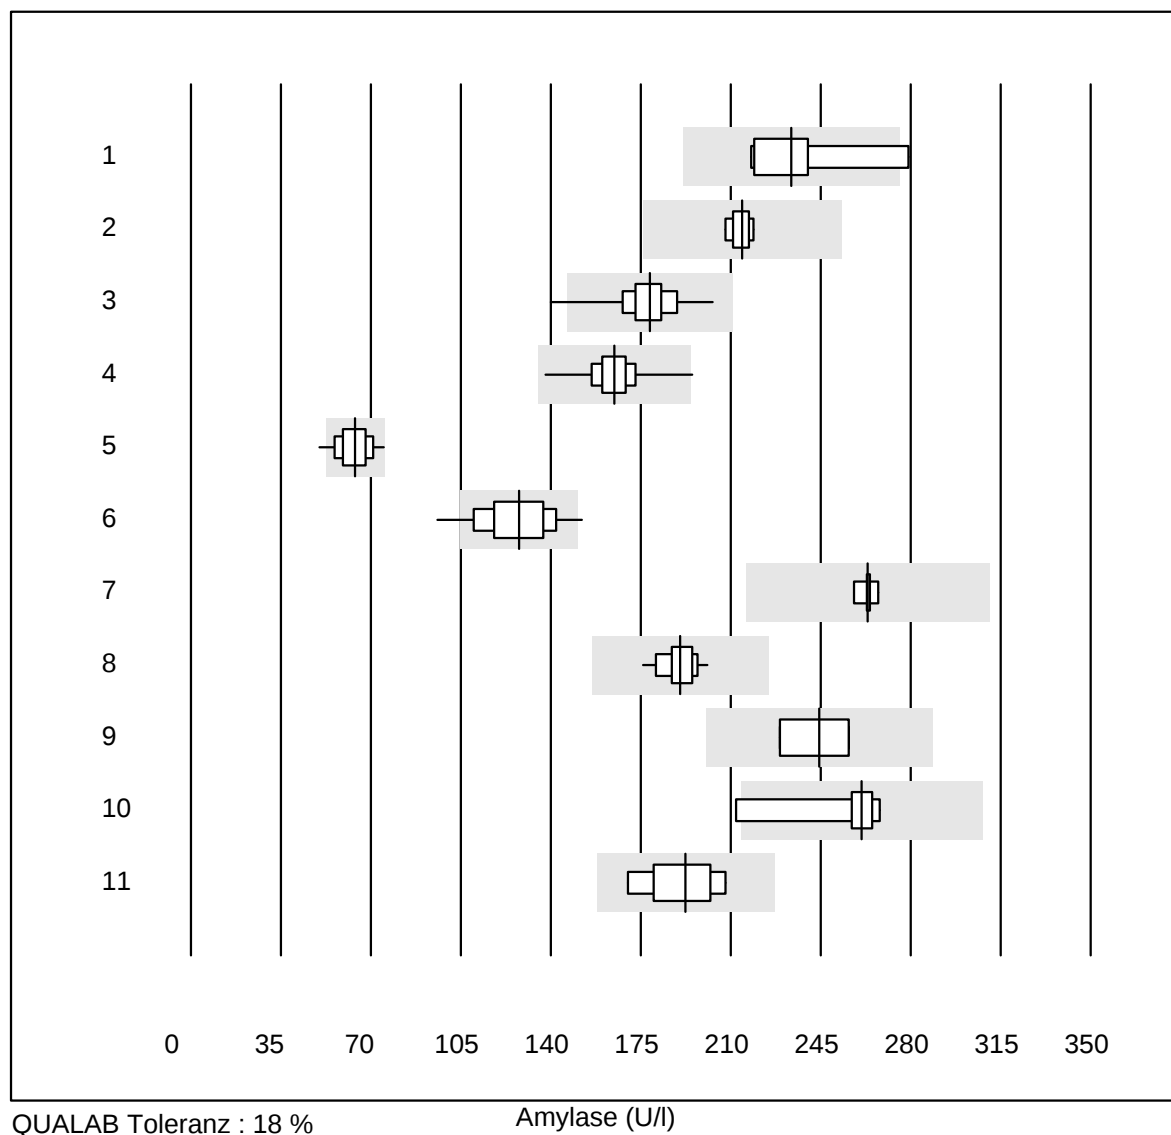


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	8	87.5	12.5	0.0	234	9.0	e*
2 Cobas	8	100.0	0.0	0.0	215	1.7	e
3 Reflotron	114	96.5	0.9	2.6	179	4.8	e
4 Fuji Dri-Chem	603	99.5	0.2	0.3	165	4.3	e
5 Spotchem/Ready	43	69.8	2.3	27.9	64	9.9	e
6 Spotchem D-Concept	242	95.5	4.5	0.0	128	9.8	e
7 Architect	5	100.0	0.0	0.0	263	1.3	e
8 Piccolo	42	100.0	0.0	0.0	190	3.2	e
9 Abx Mira	4	100.0	0.0	0.0	245	6.0	e*
10 Hitachi S40/M40	7	85.7	14.3	0.0	261	7.6	e*
11 Autolyser/DiaSys	7	100.0	0.0	0.0	192	7.2	e*

Amylase pancréatique

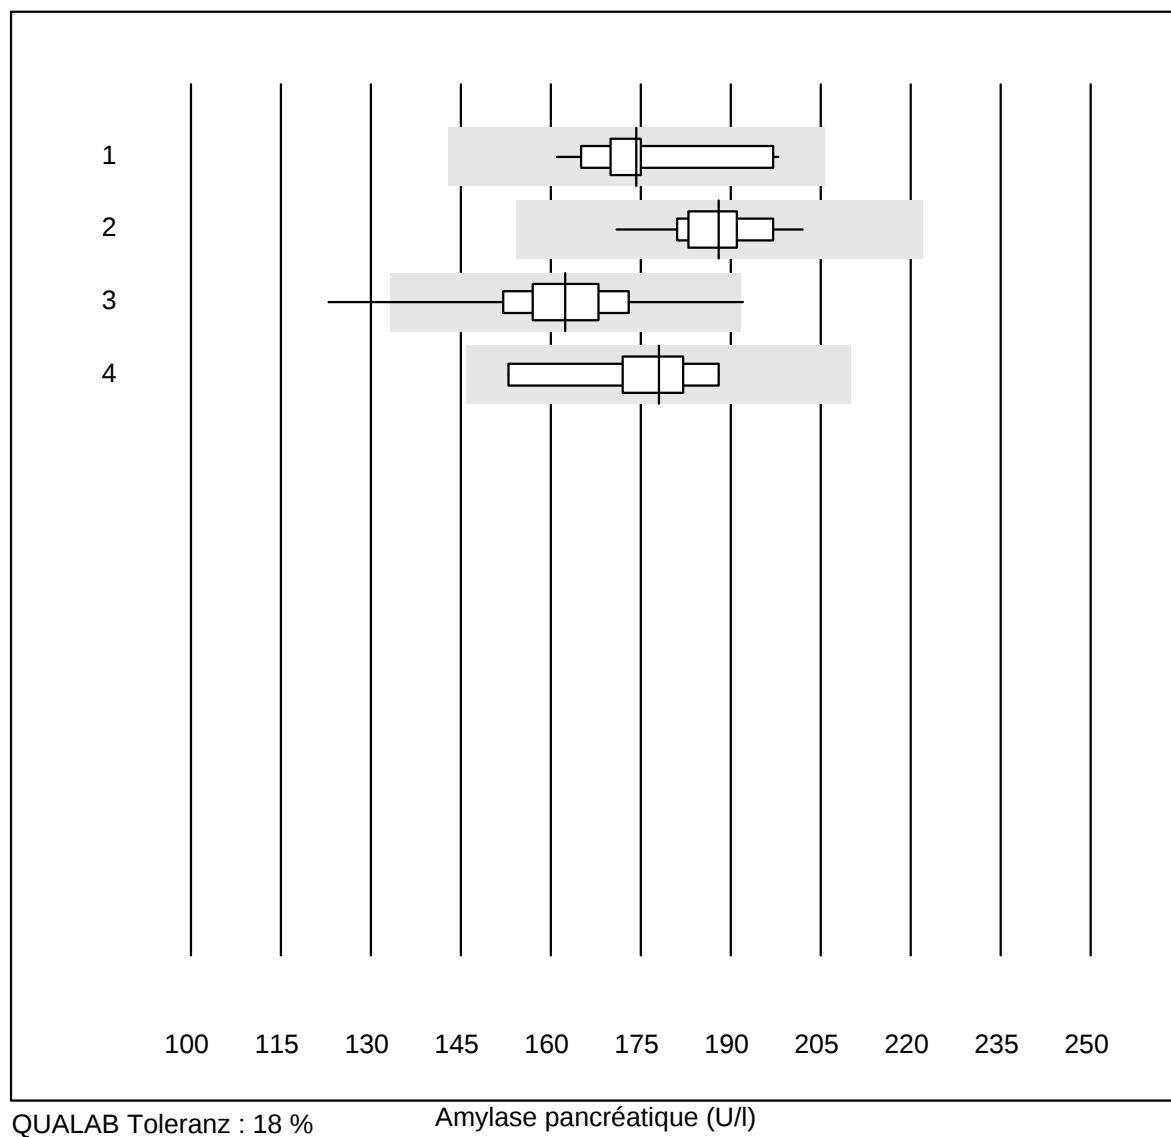


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	17	100.0	0.0	0.0	174	5.6	e
2 Cobas	13	100.0	0.0	0.0	188	4.2	e
3 Reflotron	313	97.4	1.3	1.3	162	5.4	e
4 Autolyser/DiaSys	9	100.0	0.0	0.0	178	5.7	e

Bilirubine totale

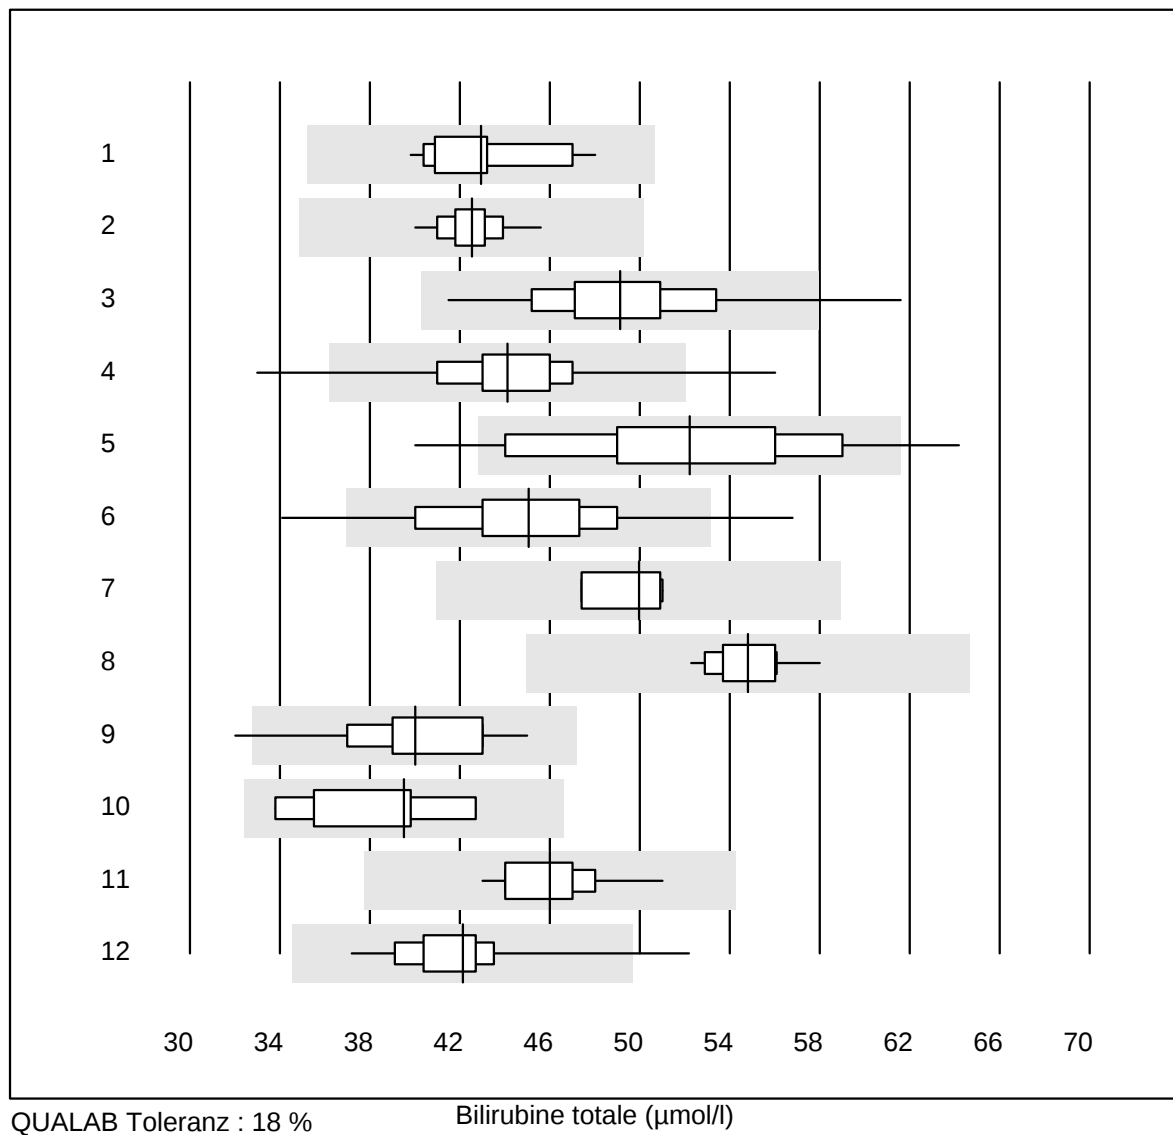

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	12	100.0	0.0	0.0	43.0	6.0	e
2	Cobas	20	100.0	0.0	0.0	42.5	3.0	e
3	Reflotron	334	96.1	1.8	2.1	49.1	6.7	e
4	Fuji Dri-Chem	651	98.6	0.6	0.8	44.1	5.2	e
5	Spotchem/Ready	52	88.5	9.6	1.9	52.2	10.6	e
6	Spotchem D-Concept	244	96.8	2.0	1.2	45.1	7.5	e
7	Dimension	4	100.0	0.0	0.0	50.0	3.5	e
8	Beckman	11	100.0	0.0	0.0	54.8	2.9	e
9	Piccolo	51	94.1	2.0	3.9	40.0	7.0	e
10	Abx Mira	9	88.9	0.0	11.1	39.5	7.5	e*
11	Hitachi S40/M40	13	100.0	0.0	0.0	46.0	4.9	e
12	Autolyser/DiaSys	16	93.7	6.3	0.0	42.1	7.5	e

Bilirubine directe

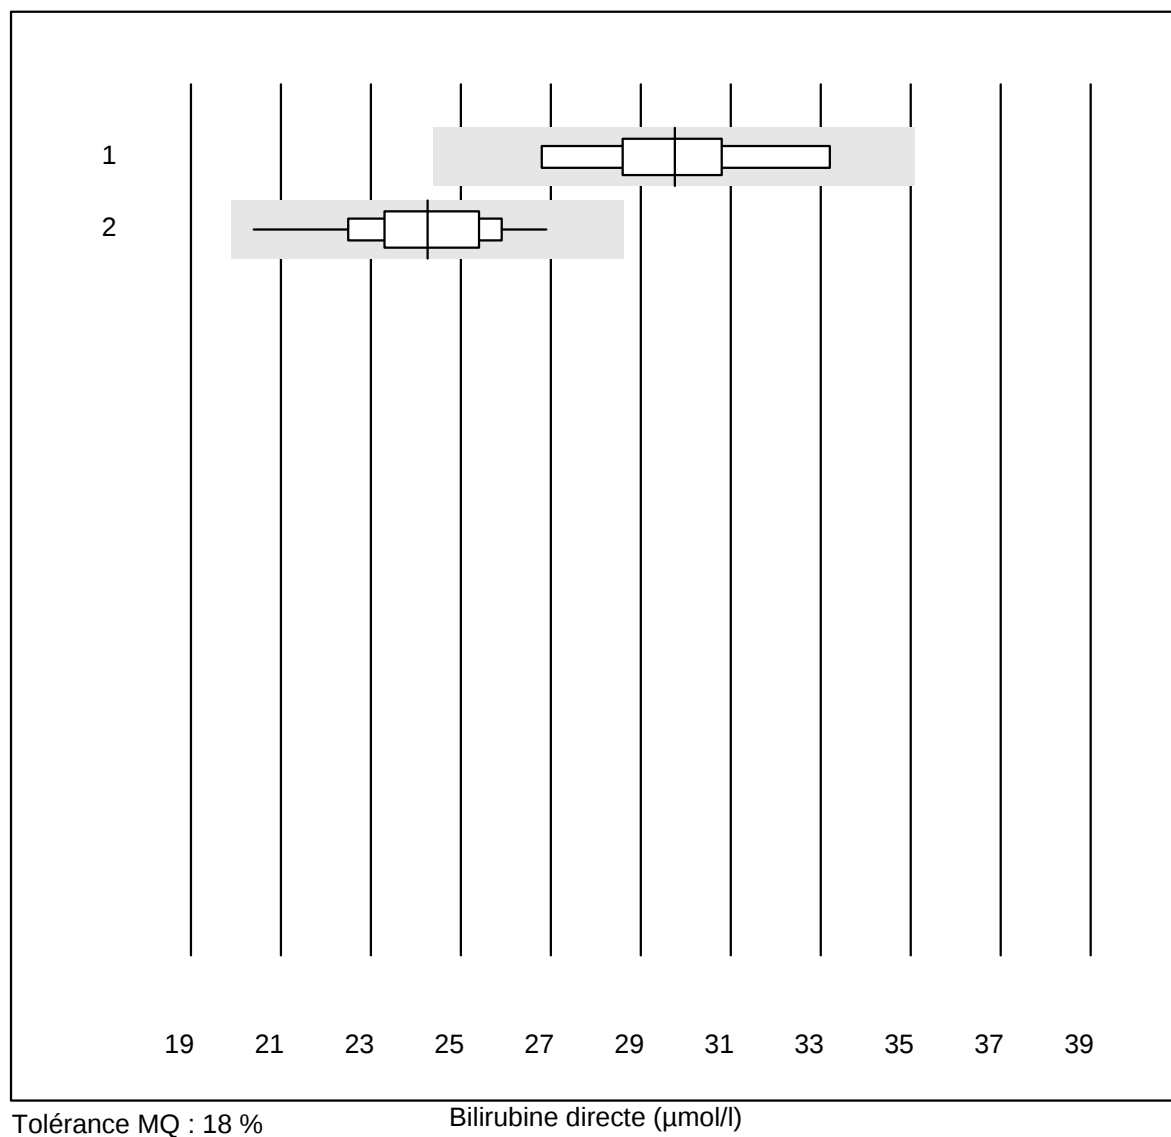


Tolérance MQ : 18 %

Bilirubine directe (µmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Autolyser/DiaSys	6	100.0	0.0	0.0	29.8	7.2	e*
2	Fuji Dri-Chem	26	100.0	0.0	0.0	24.3	6.1	e

Calcium

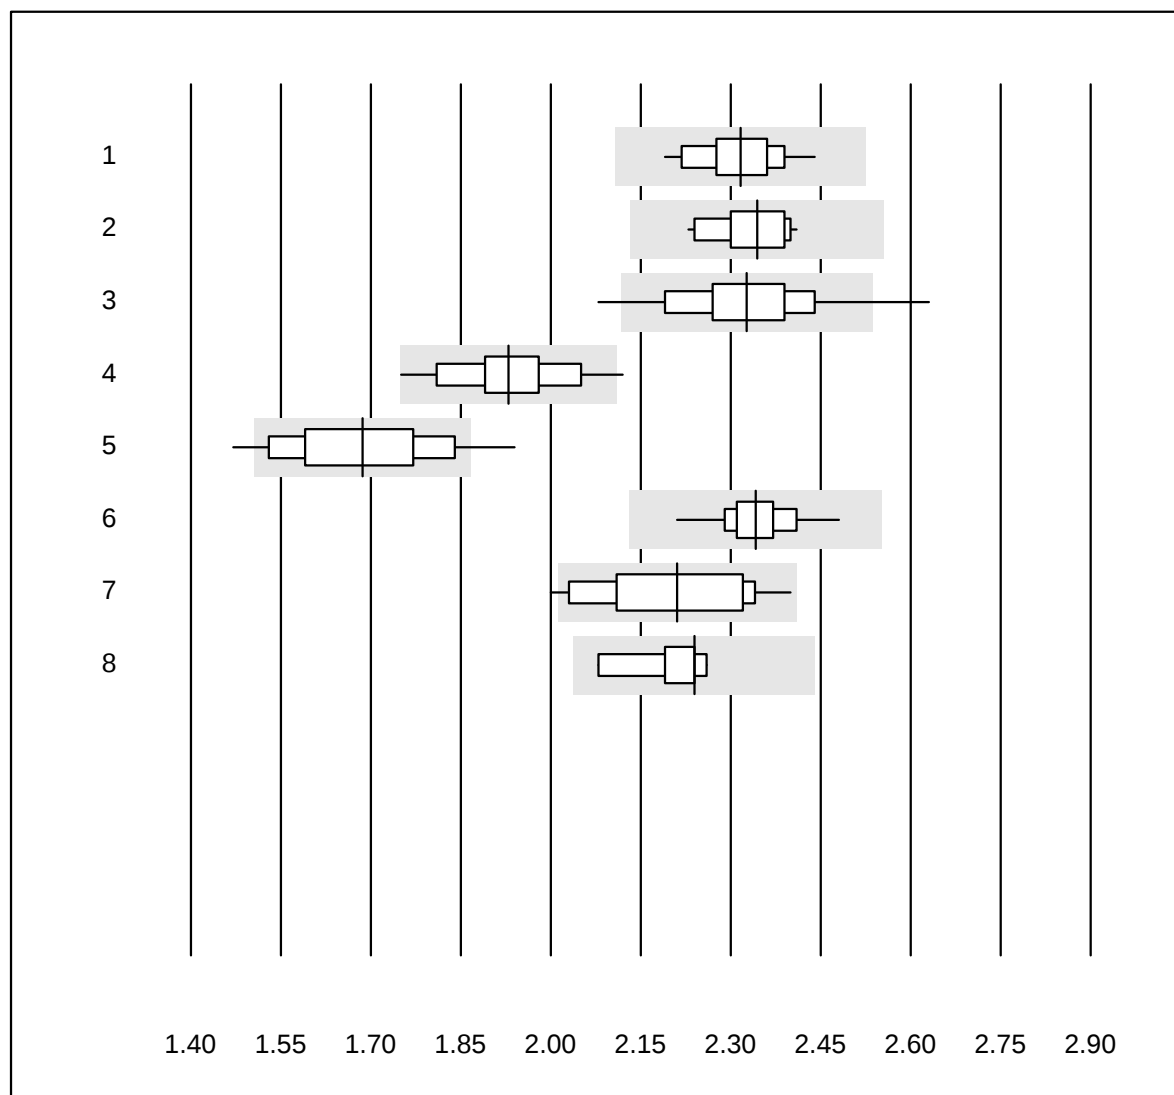


QUALAB Toleranz : 9 %
(< 2.00: +/- 0.18 mmol/l)

Calcium (mmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	29	100.0	0.0	0.0	2.32	2.6	e
2	Cobas	23	100.0	0.0	0.0	2.34	2.5	e
3	Fuji Dri-Chem	352	97.4	2.0	0.6	2.33	4.0	e
4	Spotchem/Ready	16	74.9	6.3	18.8	1.93	5.0	e*
5	Spotchem D-Concept	90	73.3	10.0	16.7	1.69	6.9	e
6	Piccolo	48	95.8	0.0	4.2	2.34	2.1	e
7	Hitachi S40/M40	11	90.9	9.1	0.0	2.21	5.9	e*
8	Autolyser/DiaSys	9	100.0	0.0	0.0	2.24	2.7	e

Calcium ISE

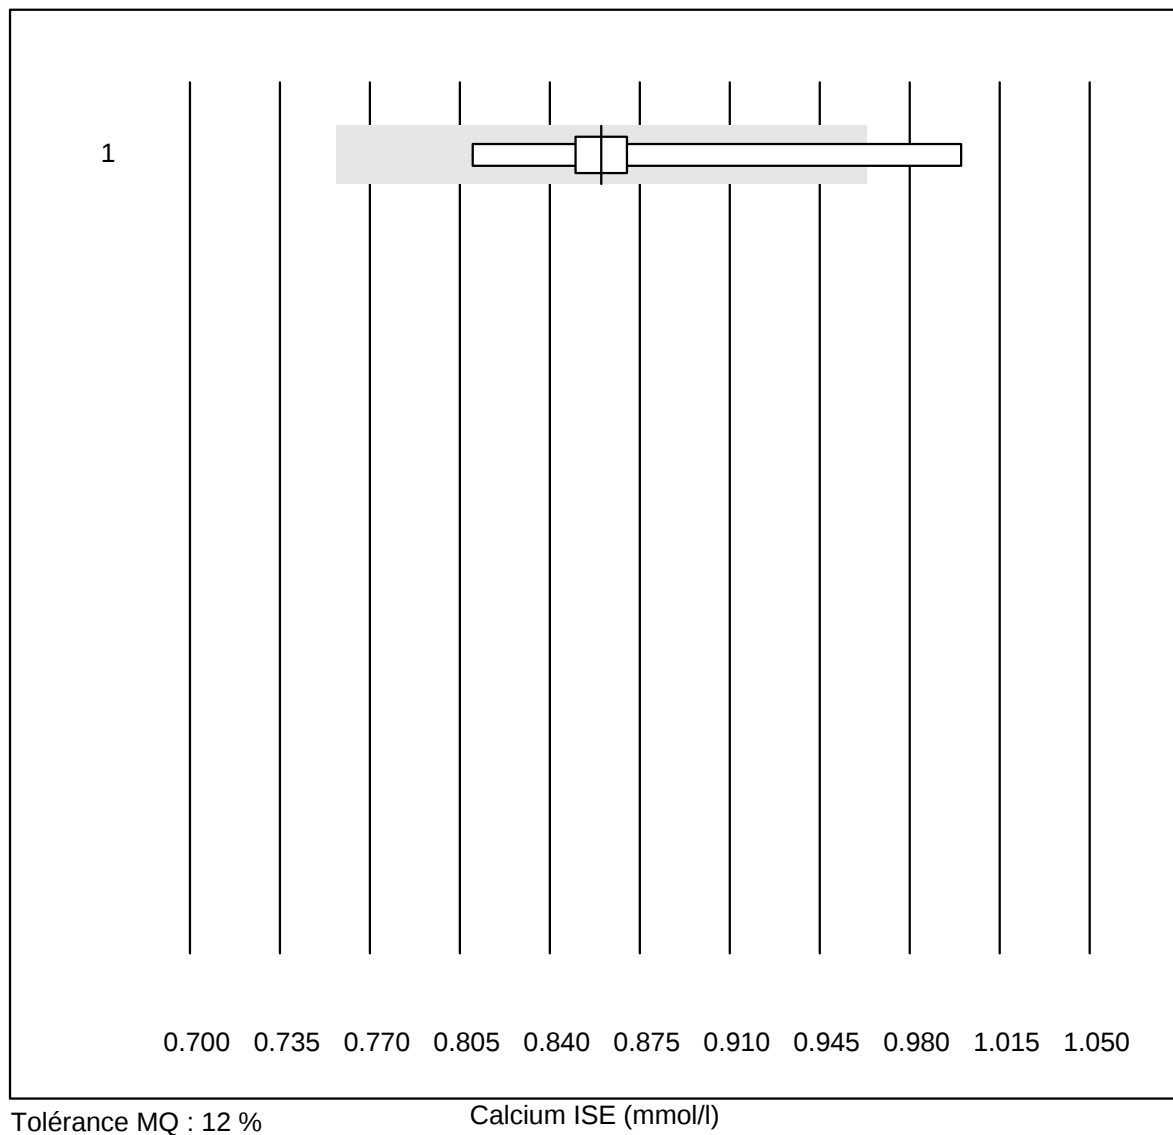


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	iStat Chem8	6	83.3	16.7	0.0	0.86	7.4	e*

Chlorures

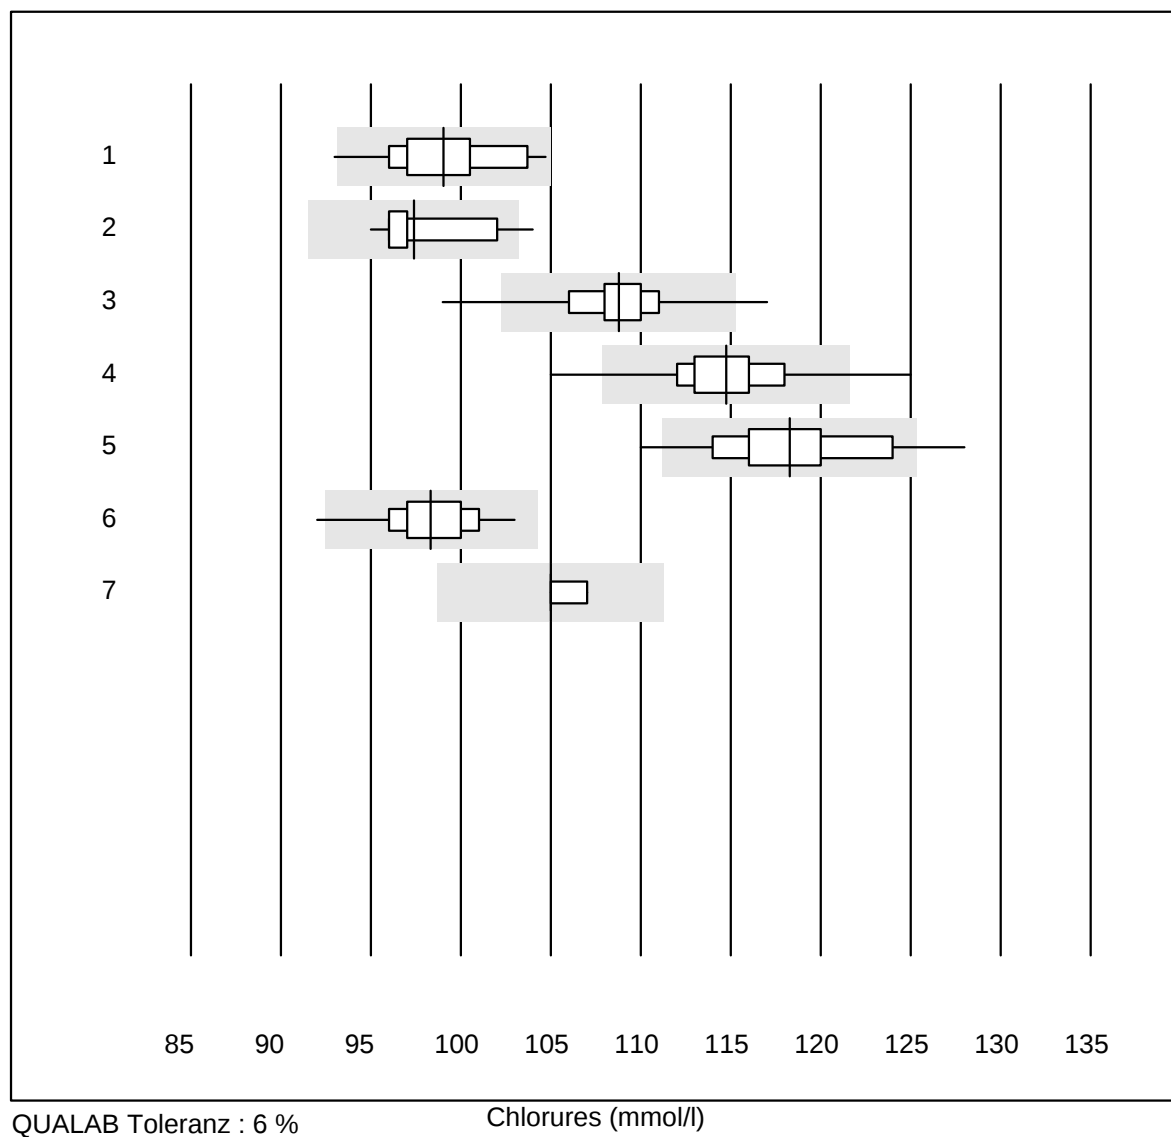


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 ISE	29	96.6	3.4	0.0	99	2.8	e
2 Cobas	13	92.3	7.7	0.0	97	2.7	e*
3 Fuji Dri-Chem	746	97.6	2.0	0.4	109	2.1	e
4 Spotchem D-Concept	281	95.7	3.6	0.7	115	2.3	e
5 Spotchem EL-SE 1520	65	87.7	7.7	4.6	118	3.2	e
6 Piccolo	24	95.8	4.2	0.0	98	2.4	e
7 iStat Chem8	5	100.0	0.0	0.0	105	0.8	e

Cholestérol

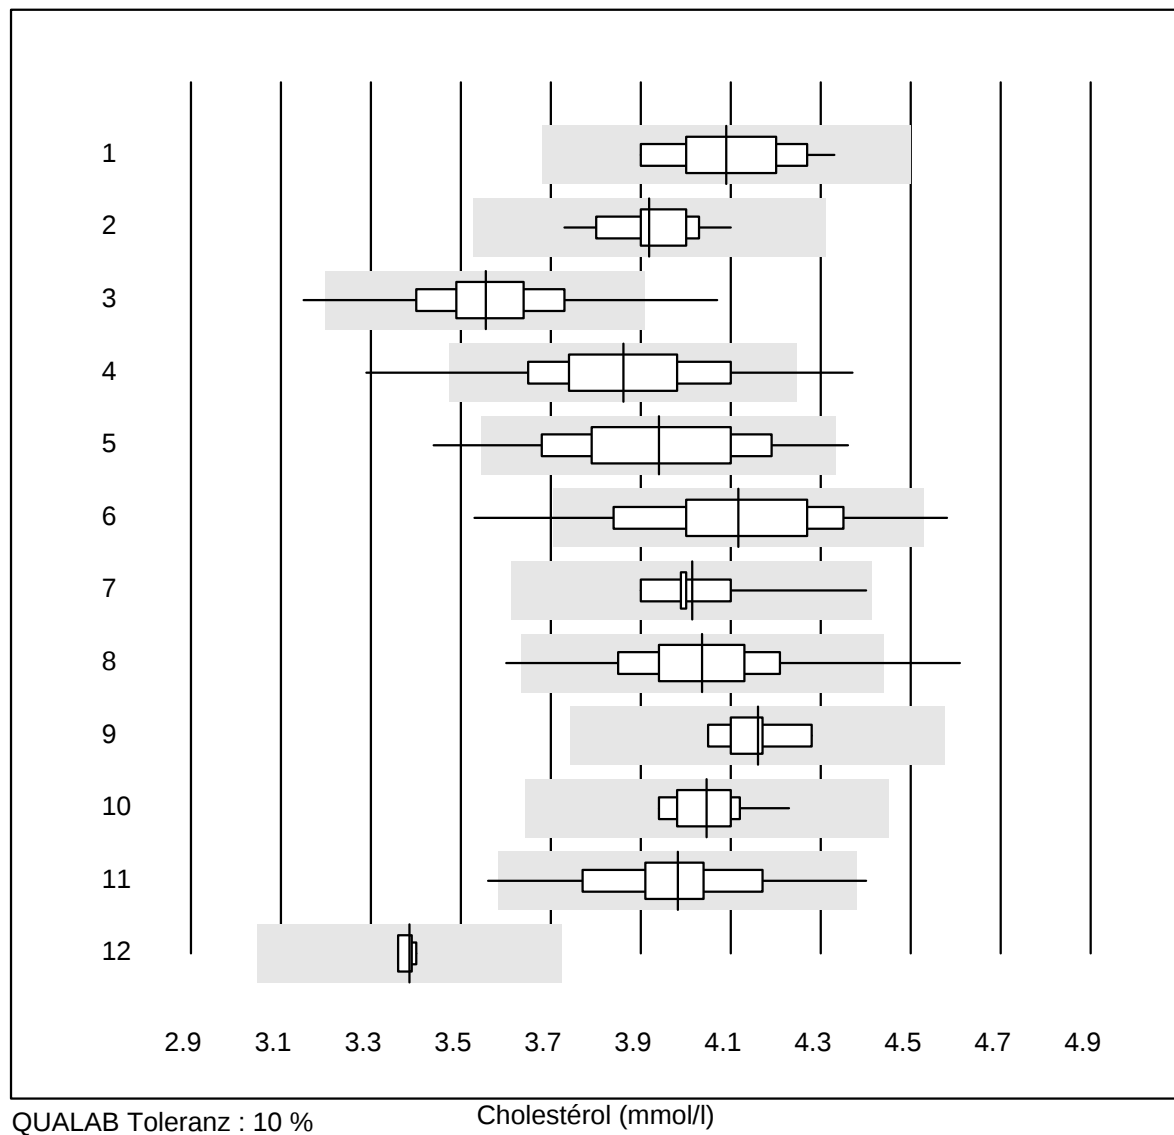


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	28	96.4	0.0	3.6	4.09	3.2	e
2	Cobas	21	100.0	0.0	0.0	3.92	2.5	e
3	Reflotron	376	97.9	1.3	0.8	3.56	3.8	e
4	Fuji Dri-Chem	801	97.7	1.4	0.9	3.86	4.4	e
5	Spotchem/Ready	75	93.4	5.3	1.3	3.94	5.1	e
6	Spotchem D-Concept	307	94.8	4.9	0.3	4.12	4.9	e
7	Piccolo	21	100.0	0.0	0.0	4.01	2.8	e
8	Cholestech LDX	315	97.1	1.0	1.9	4.04	3.6	e
9	Abx Mira	7	85.7	0.0	14.3	4.16	1.9	e
10	Hitachi S40/M40	10	100.0	0.0	0.0	4.05	2.1	e
11	Autolyser/DiaSys	18	83.3	11.1	5.6	3.98	4.4	e
12	Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	3.39	0.5	e

Cholestérol HDL

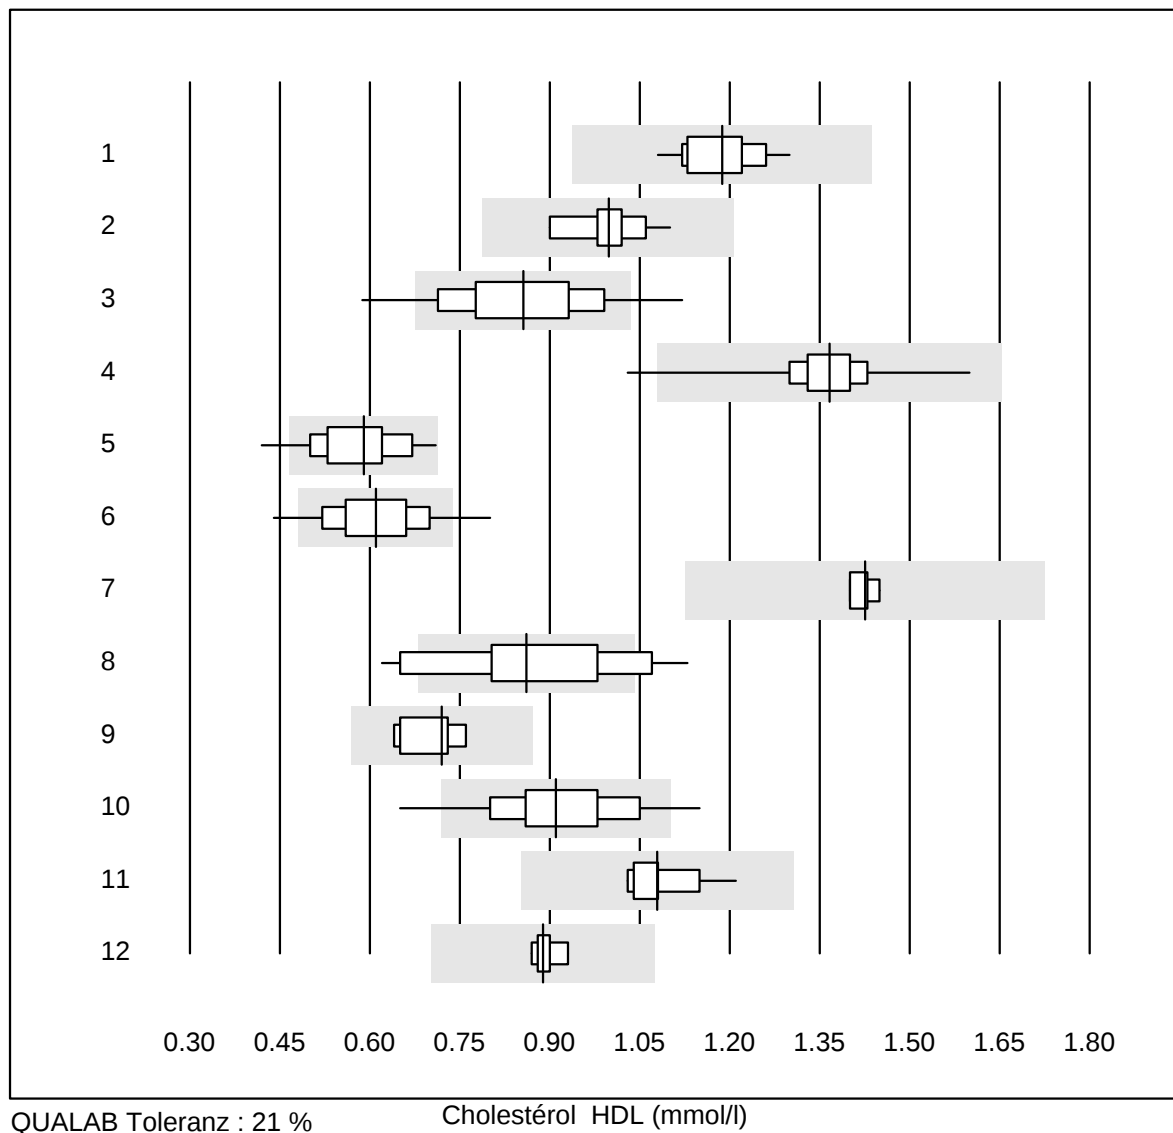


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	humide, direct	11	100.0	0.0	0.0	1.19	5.4	e
2	Cobas	19	100.0	0.0	0.0	1.00	5.2	e
3	Reflotron	271	84.2	9.2	6.6	0.86	12.6	e
4	Fuji Dri-Chem	779	99.1	0.1	0.8	1.37	3.9	e
5	Spotchem/Ready	67	91.0	6.0	3.0	0.59	11.3	e
6	Spotchem D-Concept	301	91.1	6.6	2.3	0.61	11.4	e
7	Dimension	4	100.0	0.0	0.0	1.43	1.5	e
8	Piccolo	19	73.6	21.1	5.3	0.86	15.1	e*
9	Pentra/Selectra	9	88.9	0.0	11.1	0.72	6.1	e
10	Cholestech LDX	316	93.3	3.5	3.2	0.91	10.1	e
11	Hitachi S40/M40	10	100.0	0.0	0.0	1.08	5.3	e
12	Architect	6	100.0	0.0	0.0	0.89	2.3	e
13	Autolysér/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	1.12	5.8	e

Créatine-kinase

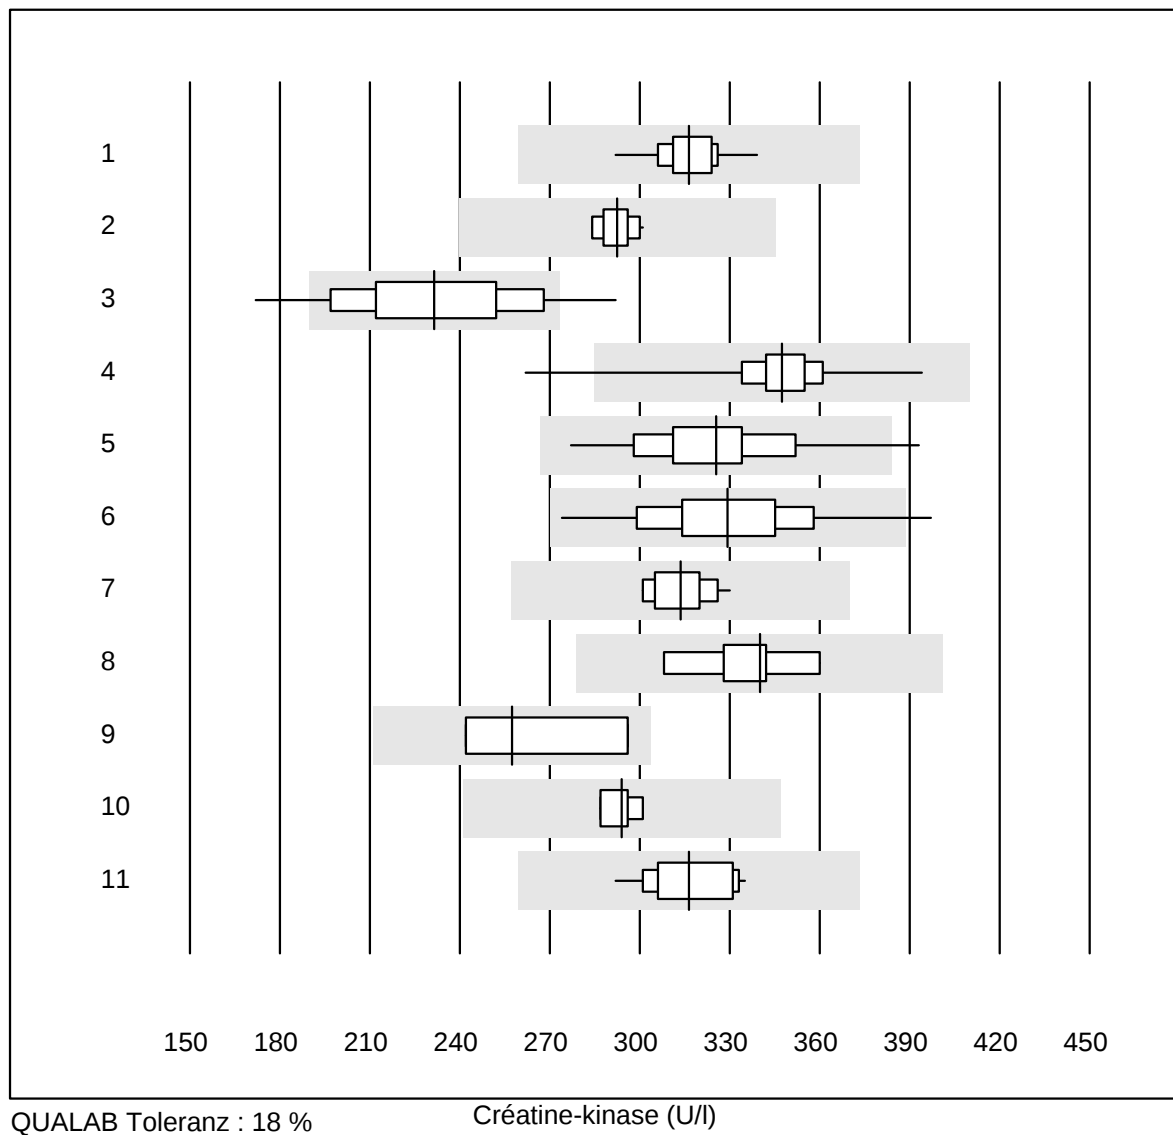


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	23	100.0	0.0	0.0	316	3.2	e
2 Cobas	19	100.0	0.0	0.0	292	1.8	e
3 Reflotron	303	83.8	8.9	7.3	232	11.2	e
4 Fuji Dri-Chem	542	97.9	0.6	1.5	347	3.9	e
5 Spotchem/Ready	33	97.0	3.0	0.0	325	7.1	e
6 Spotchem D-Concept	191	98.5	0.5	1.0	329	6.8	e
7 Piccolo	16	100.0	0.0	0.0	314	2.9	e
8 Abx Mira	5	100.0	0.0	0.0	340	5.7	e*
9 Hitachi S40/M40	4	75.0	0.0	25.0	258	10.0	e*
10 Dimension	4	100.0	0.0	0.0	294	2.0	e
11 Autolyser/DiaSys	15	100.0	0.0	0.0	316	4.3	e

Cholestérol LDL

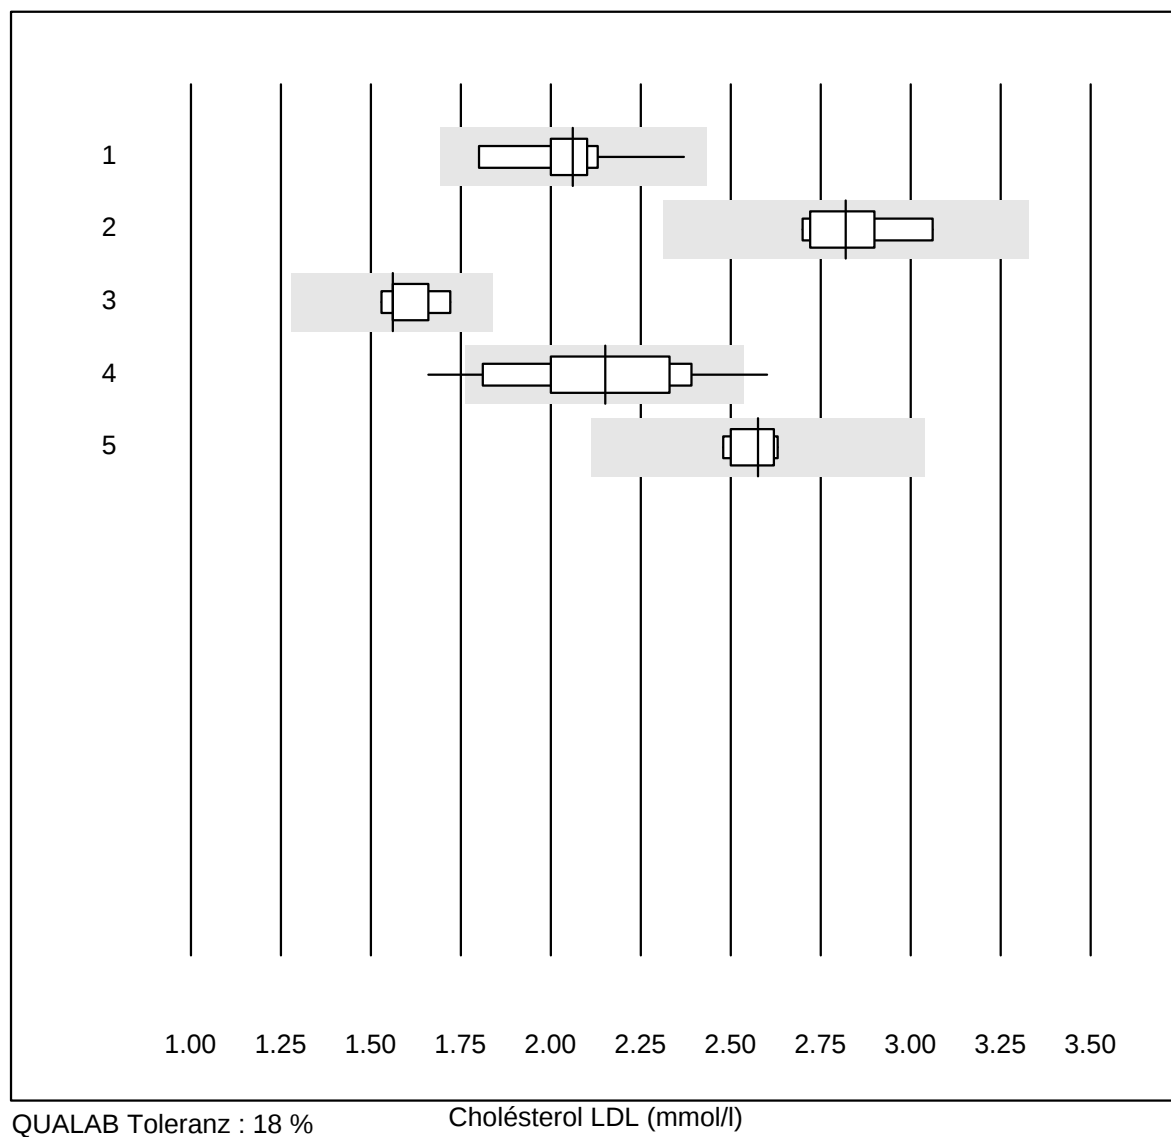


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	10	100.0	0.0	0.0	2.1	6.9	e*
2	Roche, Cobas	8	100.0	0.0	0.0	2.8	4.2	e
3	Hitachi S40/M40	5	100.0	0.0	0.0	1.6	5.0	e*
4	Autolyser/DiaSys	13	84.6	15.4	0.0	2.2	11.9	e*
5	Beckman	8	100.0	0.0	0.0	2.6	2.3	e

Fer

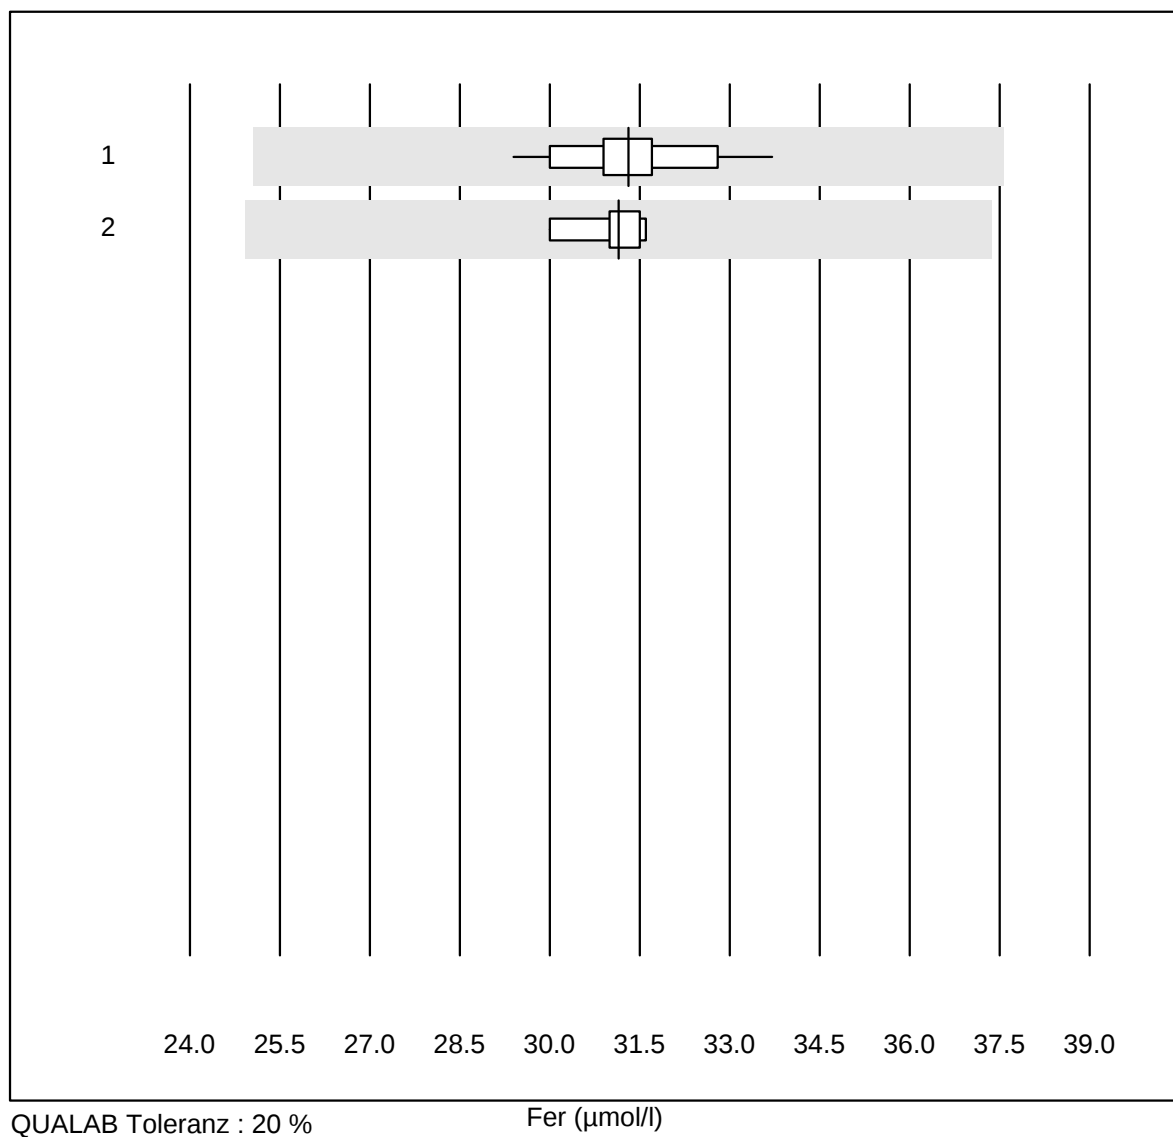


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	16	100.0	0.0	0.0	31	3.2	e
2	Cobas	10	100.0	0.0	0.0	31	1.5	e

Gamma-GT

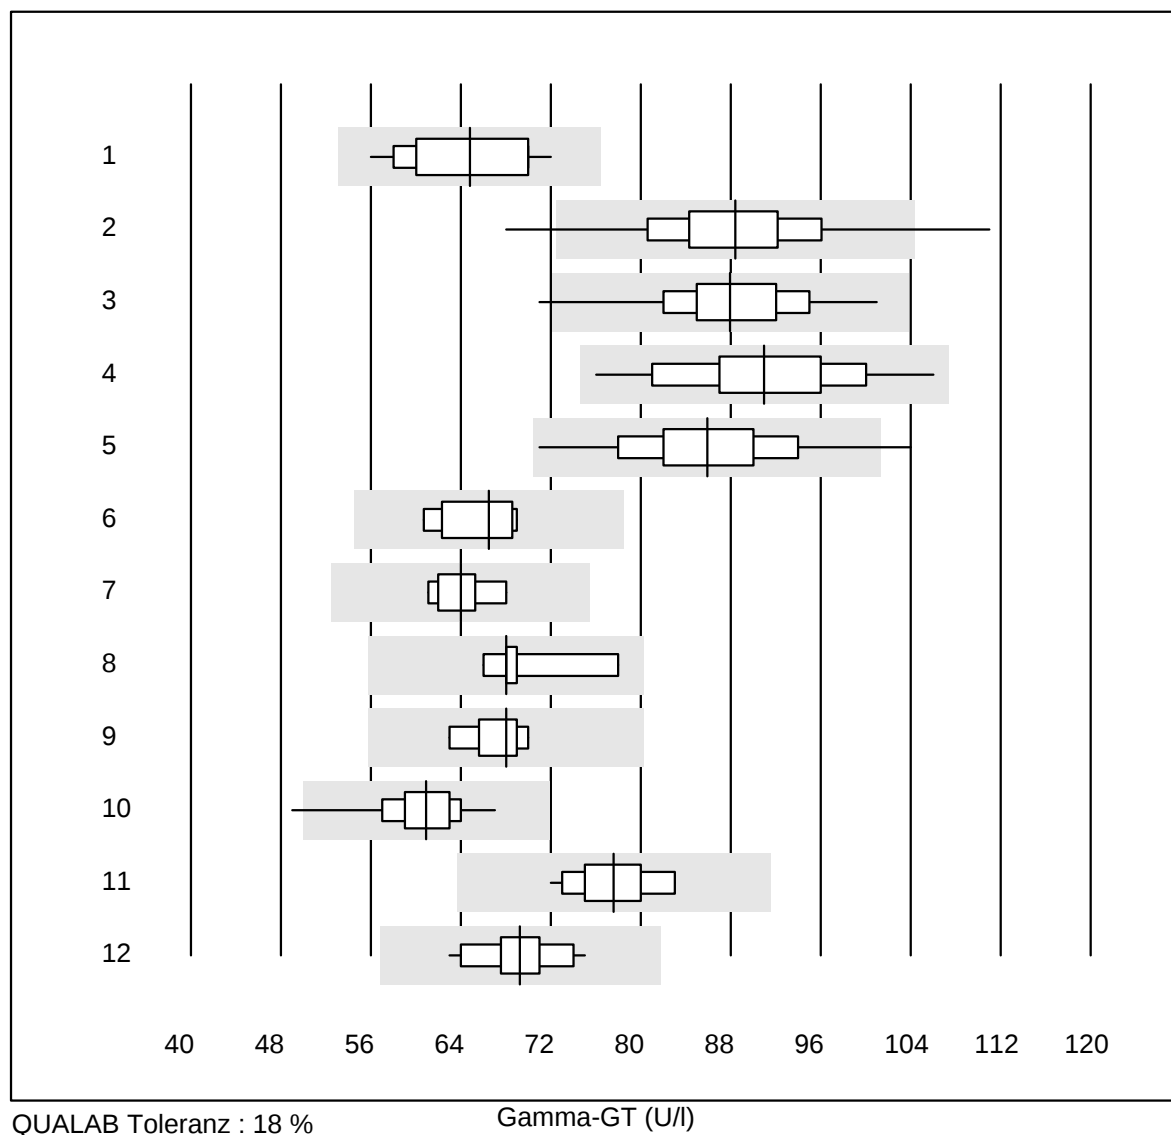


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	22	100.0	0.0	0.0	65	7.6	e
2 Reflotron	591	97.3	0.8	1.9	88	6.9	e
3 Fuji Dri-Chem	894	99.3	0.1	0.6	88	5.6	e
4 Spotchem/Ready	82	100.0	0.0	0.0	91	7.7	e
5 Spotchem D-Concept	346	98.8	0.3	0.9	86	7.0	e
6 Selectra/Biolis	6	100.0	0.0	0.0	67	5.2	e
7 Architect	7	100.0	0.0	0.0	64	3.6	e
8 Dimension	9	100.0	0.0	0.0	68	5.4	e
9 IFCC Beckmann	7	100.0	0.0	0.0	68	3.6	e
10 Piccolo	40	97.5	2.5	0.0	61	5.3	e
11 Hitachi S40/M40	15	100.0	0.0	0.0	78	4.5	e
12 Autolysier/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	69	4.7	e

Glucose

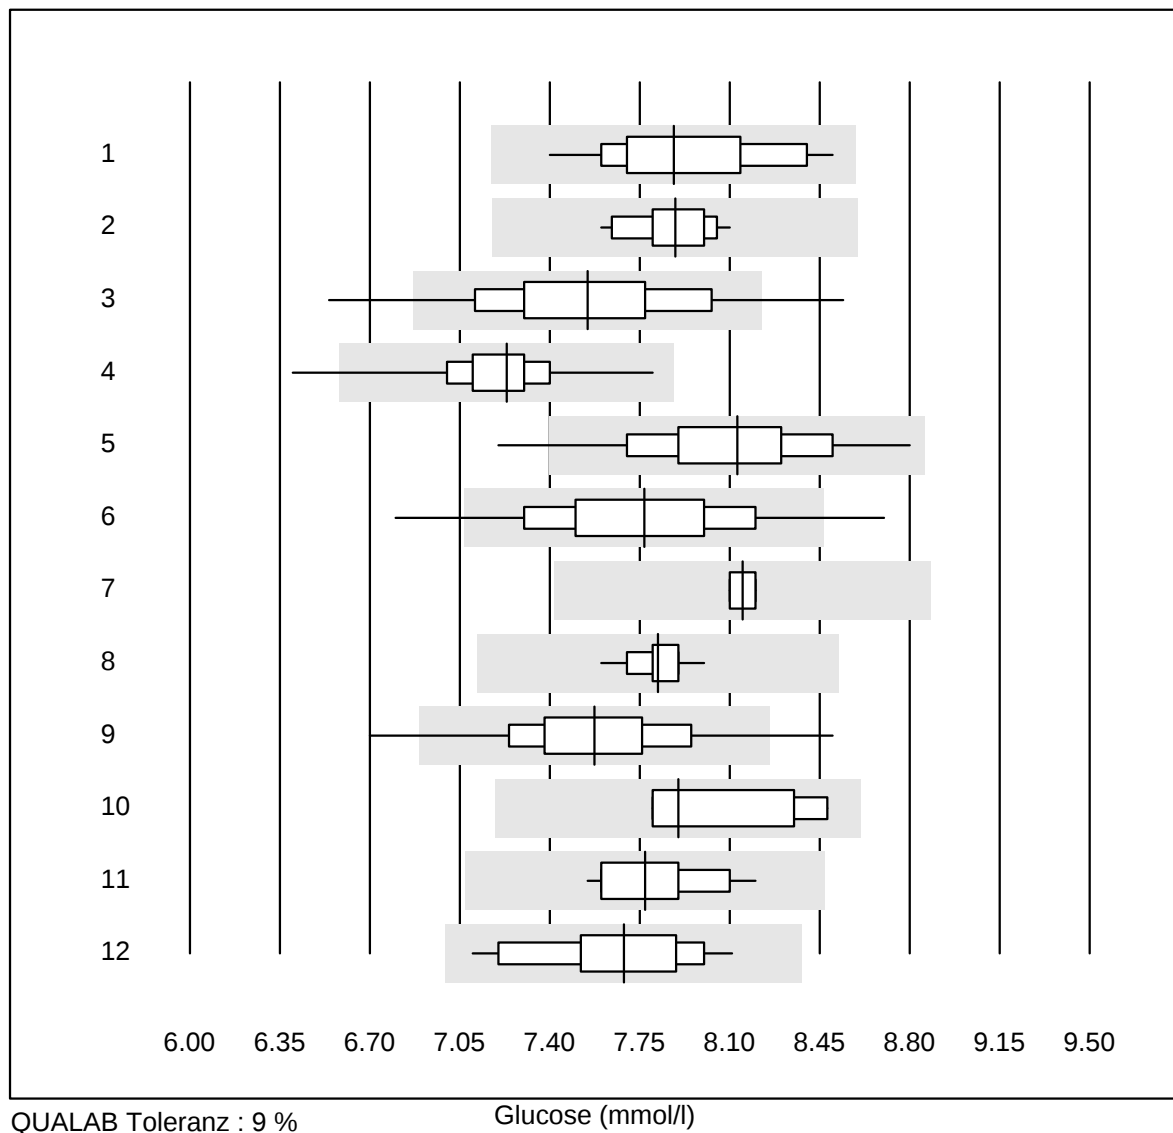


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	29	100.0	0.0	0.0	7.9	3.6	e
2	Cobas	20	100.0	0.0	0.0	7.9	1.8	e
3	Reflotron	589	91.8	5.8	2.4	7.5	4.7	e
4	Fuji Dri-Chem	847	99.3	0.5	0.2	7.2	2.3	e
5	Spotchem/Ready	75	96.0	2.7	1.3	8.1	4.1	e
6	Spotchem D-Concept	321	97.2	1.9	0.9	7.8	4.3	e
7	Dimension	4	100.0	0.0	0.0	8.2	0.7	e
8	Piccolo	55	100.0	0.0	0.0	7.8	1.3	e
9	Cholestech LDX	306	97.1	2.6	0.3	7.6	3.8	e
10	Abx Mira	7	85.7	0.0	14.3	7.9	3.8	e*
11	Hitachi S40/M40	16	100.0	0.0	0.0	7.8	2.7	e
12	Autolyser/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	7.7	3.9	e
13	iStat Chem8	7	100.0	0.0	0.0	7.1	1.6	e

Glucose

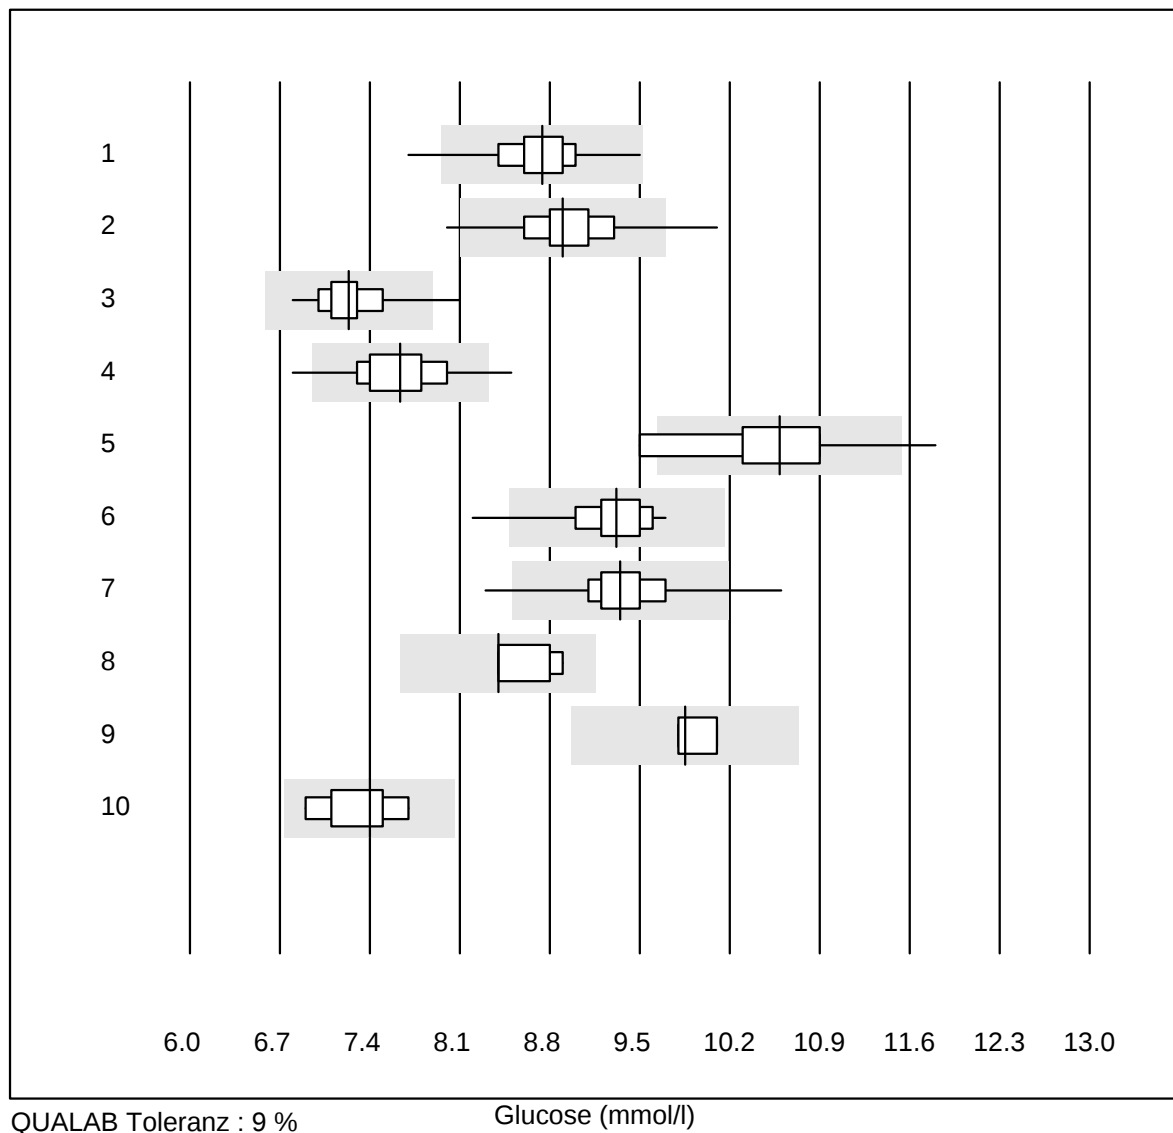


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Accu-Chek Aviva	412	97.8	1.2	1.0	8.7	3.1	e
2	Accu-Chek Inform 2	720	93.6	1.3	5.1	8.9	3.2	e
3	Accu-Check Guide	214	97.7	2.3	0.0	7.2	2.9	e
4	Contour XT	1197	97.3	1.8	0.9	7.6	3.7	e
5	Glucocard	12	66.6	16.7	16.7	10.6	5.8	e*
6	Hemocue 201+ P-equiv	99	99.0	1.0	0.0	9.3	2.5	e
7	Hemocue 201RT P-equiv	111	94.6	2.7	2.7	9.3	2.8	e
8	Freestyle Freedom li	5	100.0	0.0	0.0	8.4	2.9	e*
9	Sanofi BG Star	4	75.0	0.0	25.0	9.9	1.5	e
10	Contour NEXT ONE	9	100.0	0.0	0.0	7.4	4.0	e*

Glucose

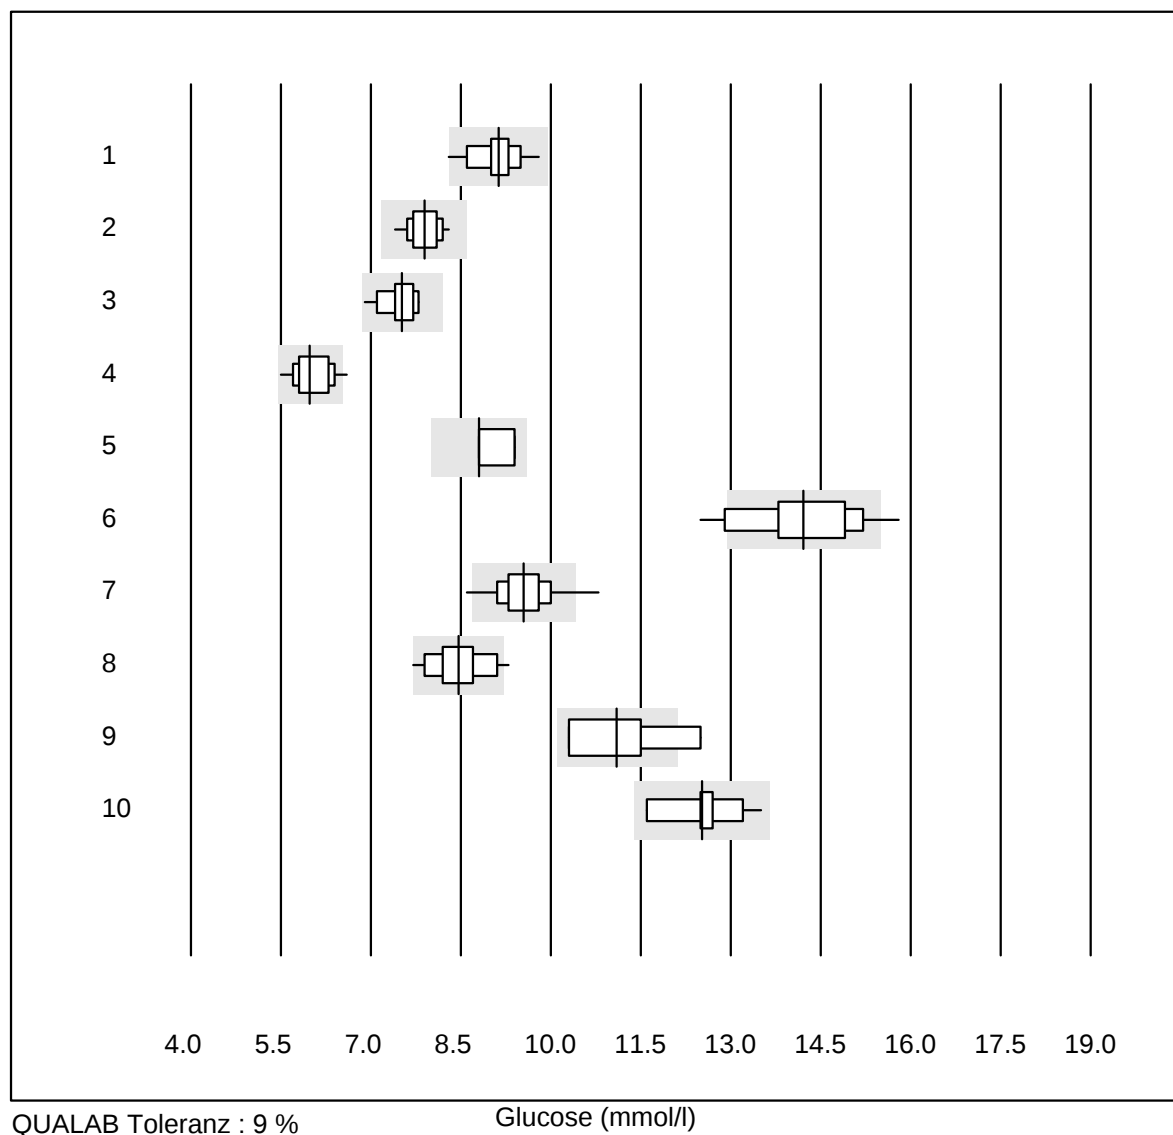


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Hemocue 201+ (alt)	42	97.6	2.4	0.0	9.1	3.9	e
2	AccuChek Sensor	30	90.0	0.0	10.0	7.9	2.9	e
3	OneTouch Verio	26	100.0	0.0	0.0	7.5	3.3	e
4	Contour 2 (5s)	18	94.4	5.6	0.0	6.0	5.3	e*
5	Contour (15s)	5	60.0	0.0	40.0	8.8	3.3	e*
6	Healthpro	36	77.7	16.7	5.6	14.2	5.7	e
7	Mylife UNIO	289	96.2	2.4	1.4	9.6	4.0	e
8	mylife Pura	69	94.2	5.8	0.0	8.5	4.7	e
9	Omnitest	9	77.8	22.2	0.0	11.1	7.3	e*
10	Alpha Check	22	72.7	0.0	27.3	12.5	4.1	e

Acide urique

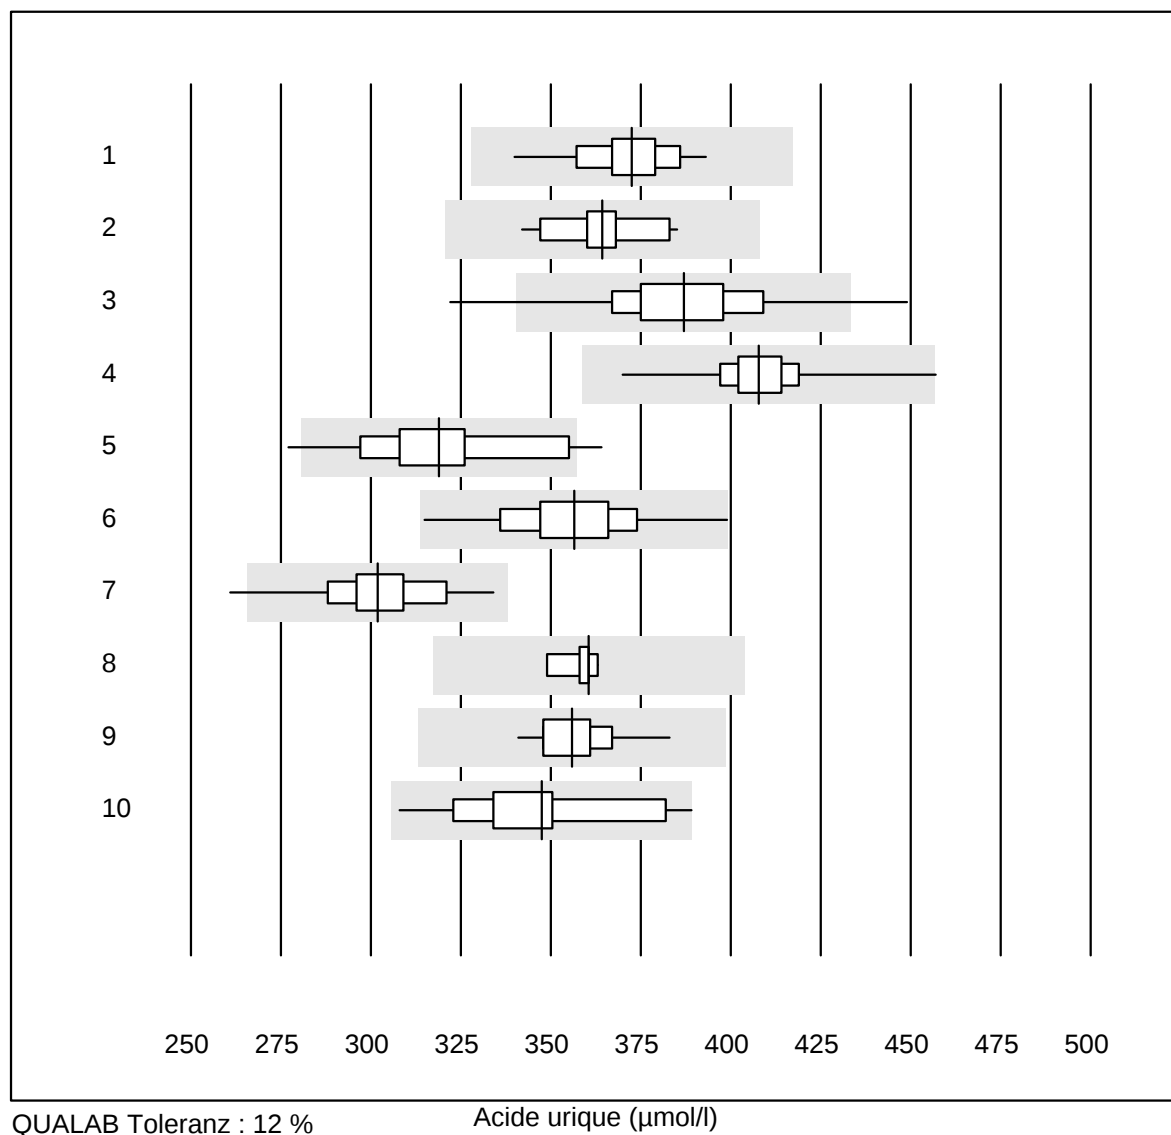


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	30	96.7	0.0	3.3	373	3.0	e
2	Cobas	19	100.0	0.0	0.0	364	2.9	e
3	Reflotron	519	96.7	2.5	0.8	387	4.7	e
4	Fuji Dri-Chem	831	99.8	0.1	0.1	408	2.3	e
5	Spotchem/Ready	64	87.5	9.4	3.1	319	6.3	e
6	Spotchem D-Concept	322	100.0	0.0	0.0	356	4.2	e
7	Piccolo	26	96.2	3.8	0.0	302	4.9	e
8	Abx Mira	7	71.4	0.0	28.6	361	1.5	e
9	Hitachi S40/M40	15	100.0	0.0	0.0	356	2.9	e
10	Autolyser/DiaSys	17	94.1	0.0	5.9	347	6.3	e*

Urée

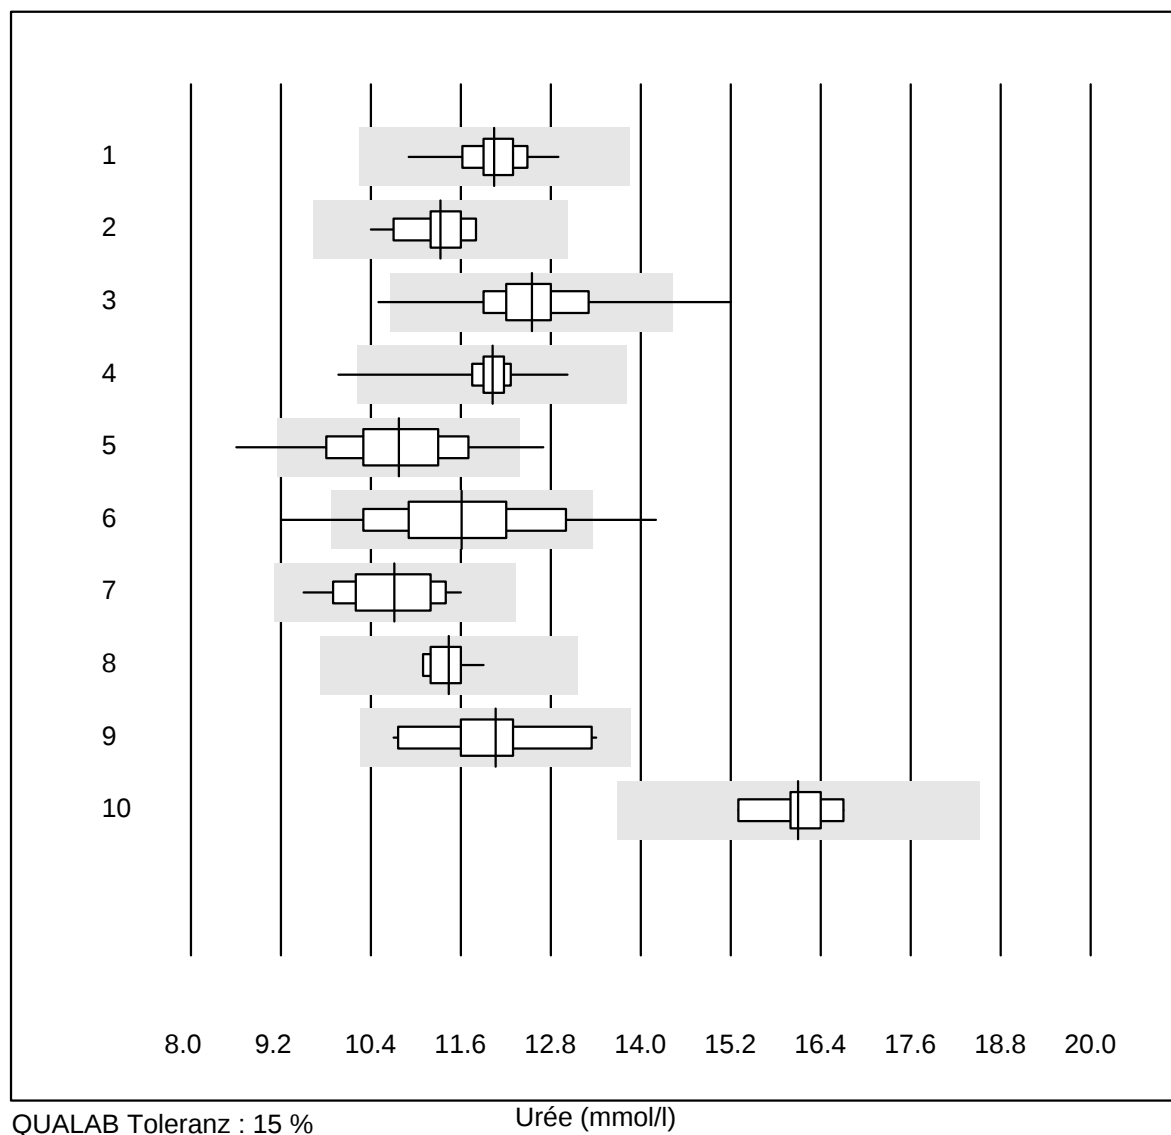


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	27	100.0	0.0	0.0	12.0	3.1	e
2	Cobas	22	100.0	0.0	0.0	11.3	3.5	e
3	Reflotron	238	97.0	1.7	1.3	12.5	4.8	e
4	Fuji Dri-Chem	495	99.0	0.2	0.8	12.0	2.2	e
5	Spotchem/Ready	45	86.7	4.4	8.9	10.8	7.2	e
6	Spotchem D-Concept	196	88.3	9.7	2.0	11.6	8.7	e
7	Piccolo	48	97.9	0.0	2.1	10.7	5.1	e
8	Hitachi S40/M40	11	100.0	0.0	0.0	11.4	2.1	e
9	Autolysier/DiaSys	14	100.0	0.0	0.0	12.1	6.4	e
10	iStat Chem8	6	100.0	0.0	0.0	16.1	2.9	e

Potassium

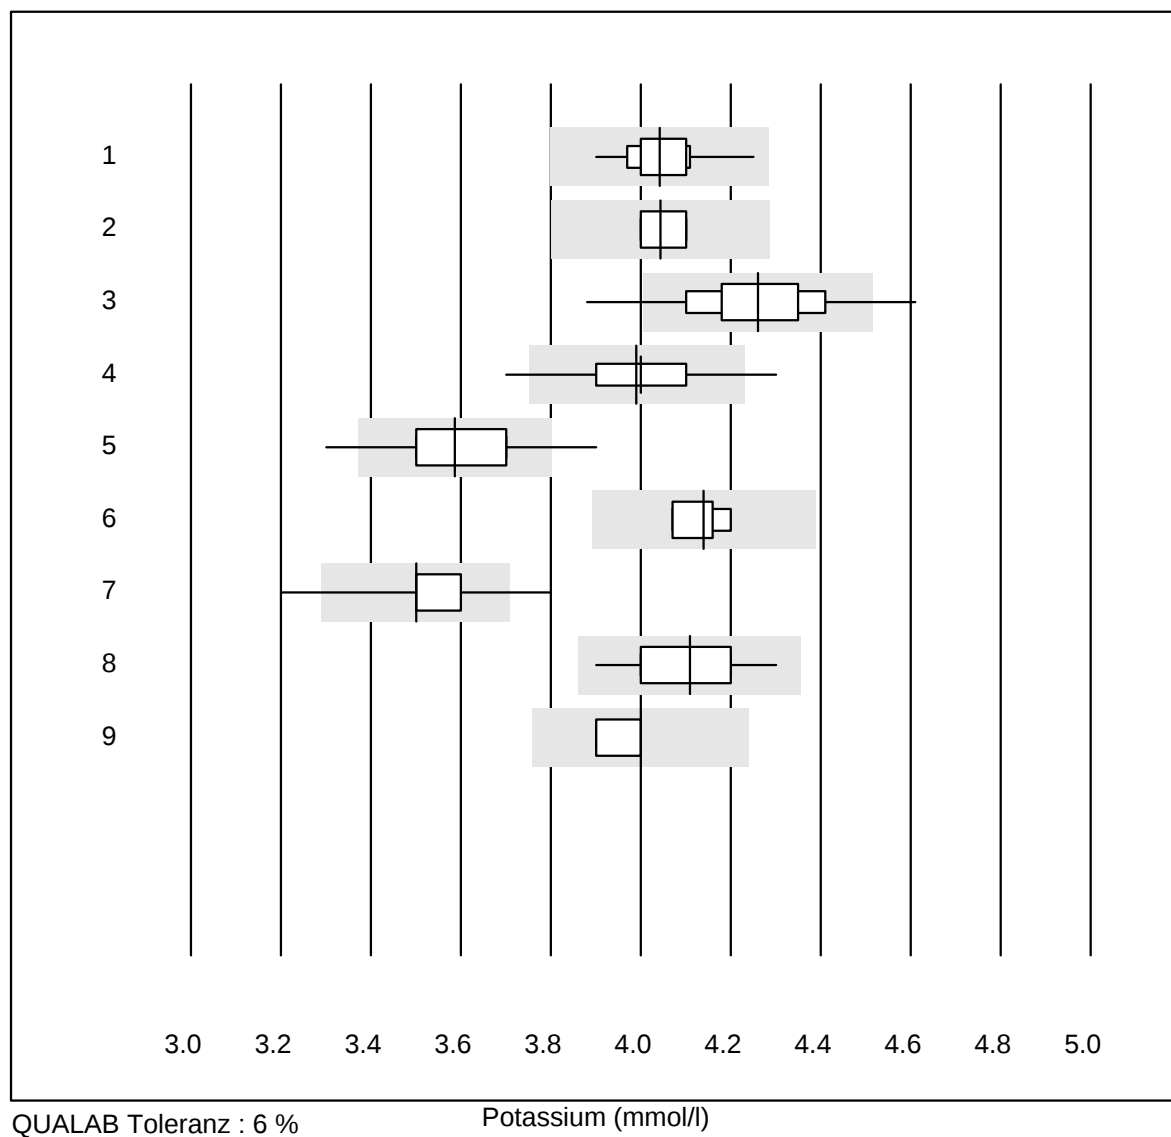

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ISE	41	100.0	0.0	0.0	4.04	1.8	e
2	Cobas	22	100.0	0.0	0.0	4.04	1.1	e
3	Reflotron	534	92.1	5.8	2.1	4.26	3.0	e
4	Fuji Dri-Chem	877	98.4	0.6	1.0	3.99	1.6	e
5	Spotchem D-Concept	327	99.1	0.6	0.3	3.59	2.7	e
6	Autolyser/DiaSys	4	100.0	0.0	0.0	4.14	1.3	e
7	Spotchem EL-SE 1520	71	95.8	2.8	1.4	3.50	2.5	e
8	Piccolo	37	89.2	0.0	10.8	4.11	2.7	e
9	iStat Chem8	8	100.0	0.0	0.0	4.00	1.3	e

Créatinine

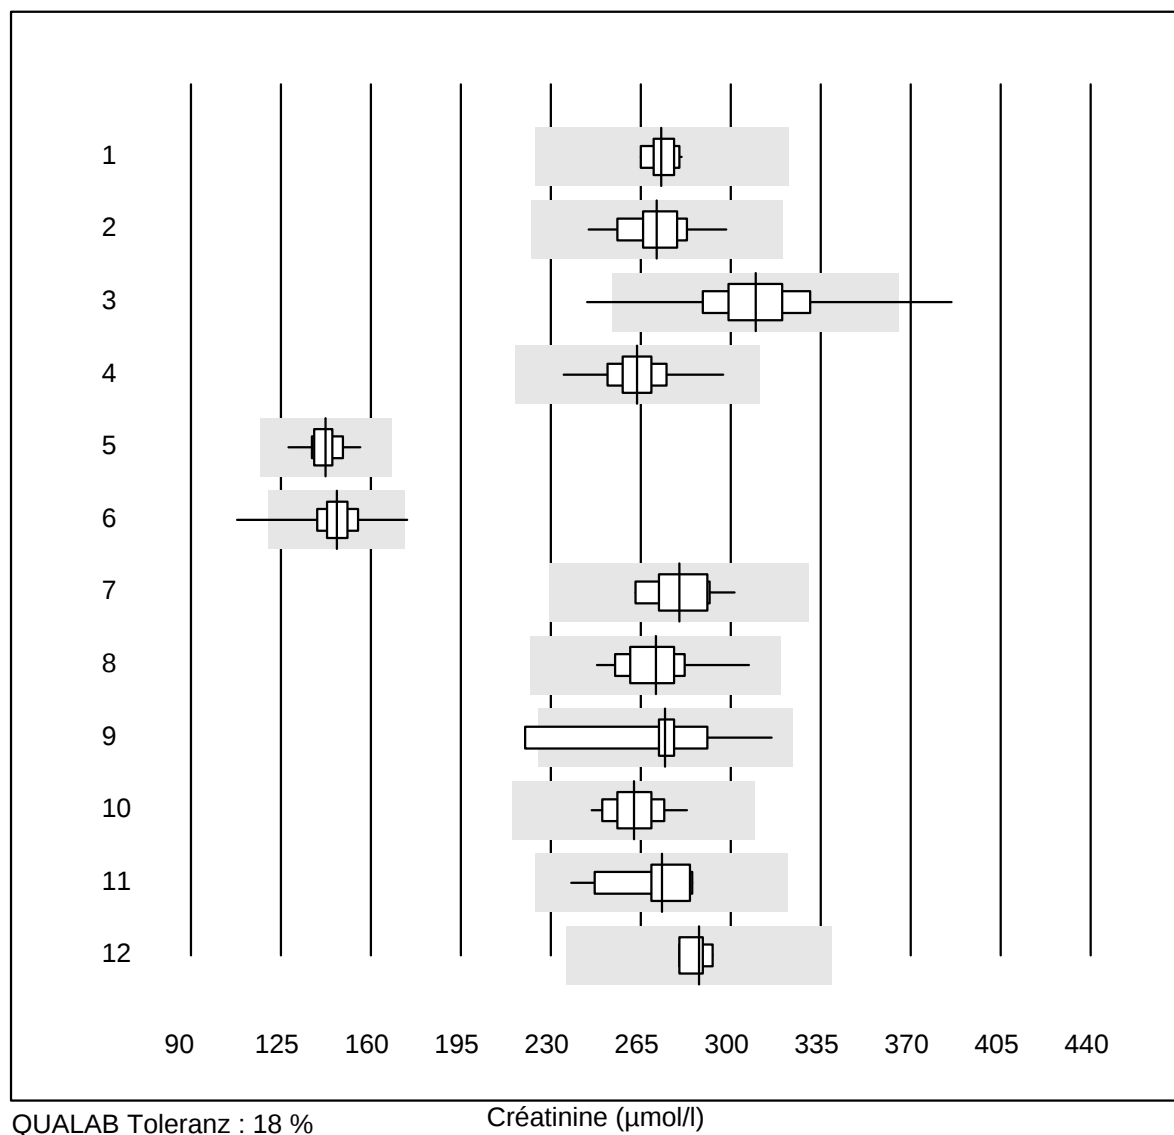


QUALAB Toleranz : 18 %

Créatinine (µmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	13	100.0	0.0	0.0	273	1.9	e
2	Cobas	21	100.0	0.0	0.0	271	4.4	e
3	Reflotron	704	97.8	0.4	1.8	310	5.4	e
4	Fuji Dri-Chem	919	99.7	0.0	0.3	264	3.5	e
5	Spotchem/Ready	90	98.9	0.0	1.1	142	3.4	e
6	Spotchem D-Concept	346	99.1	0.6	0.3	147	4.5	e
7	Enzymatisch	10	100.0	0.0	0.0	280	4.6	e
8	Piccolo	56	100.0	0.0	0.0	271	4.6	e
9	Abx Mira	10	90.0	10.0	0.0	274	8.6	e*
10	Hitachi S40/M40	16	100.0	0.0	0.0	262	3.6	e
11	Autolyser/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	273	4.8	e
12	Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	288	1.9	e
13	EPOC	9	77.8	11.1	11.1	273	9.5	e*

Créatinine E

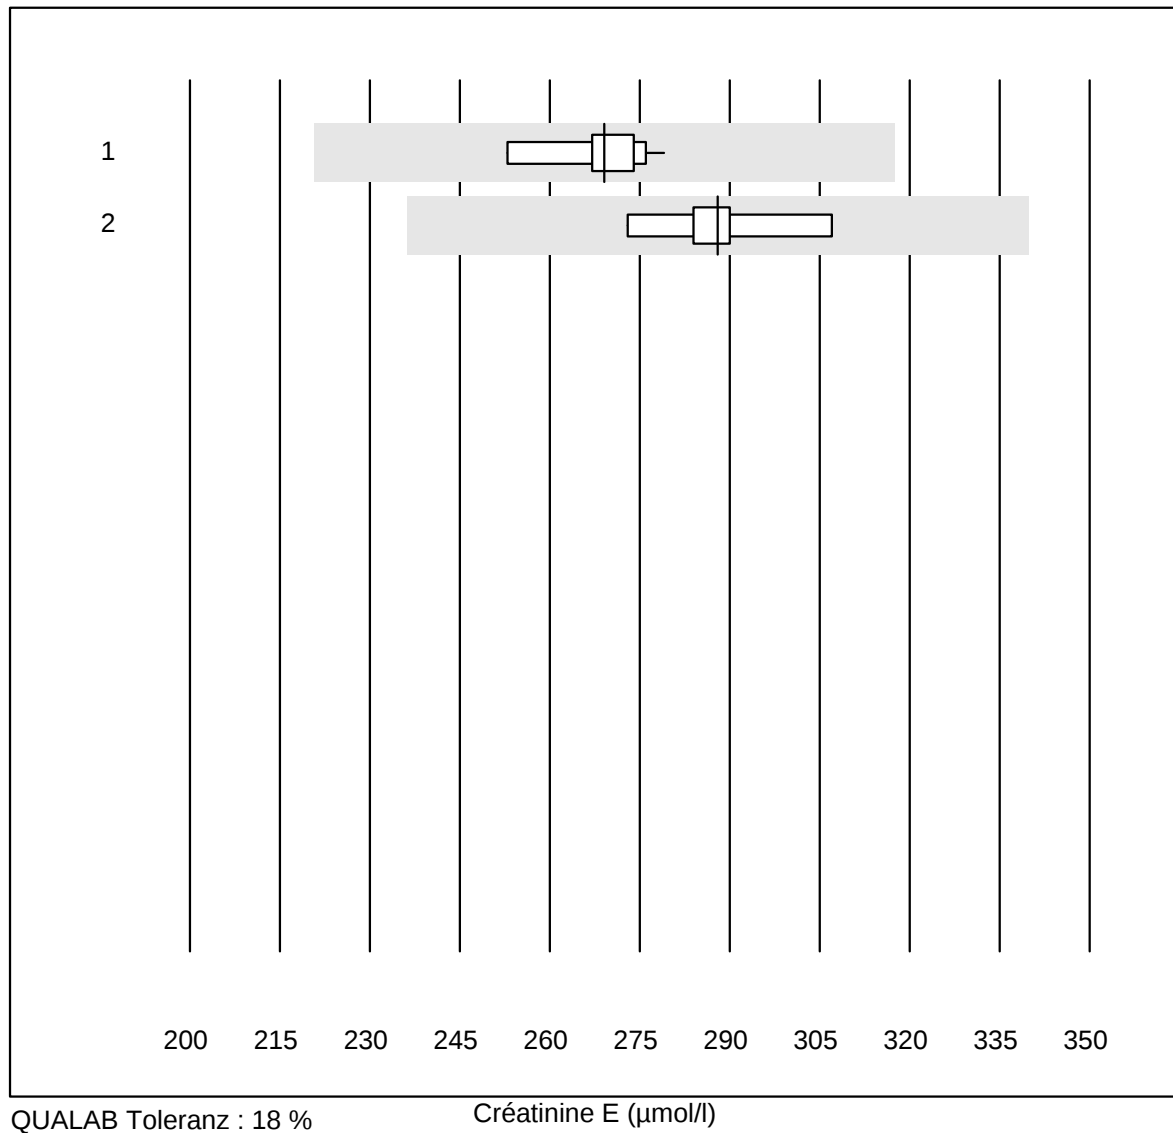


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	iStat Chem8	10	100.0	0.0	0.0	269	2.8	e
2	ABL700/800	8	100.0	0.0	0.0	288	3.8	e

eGFR CKD-EPI

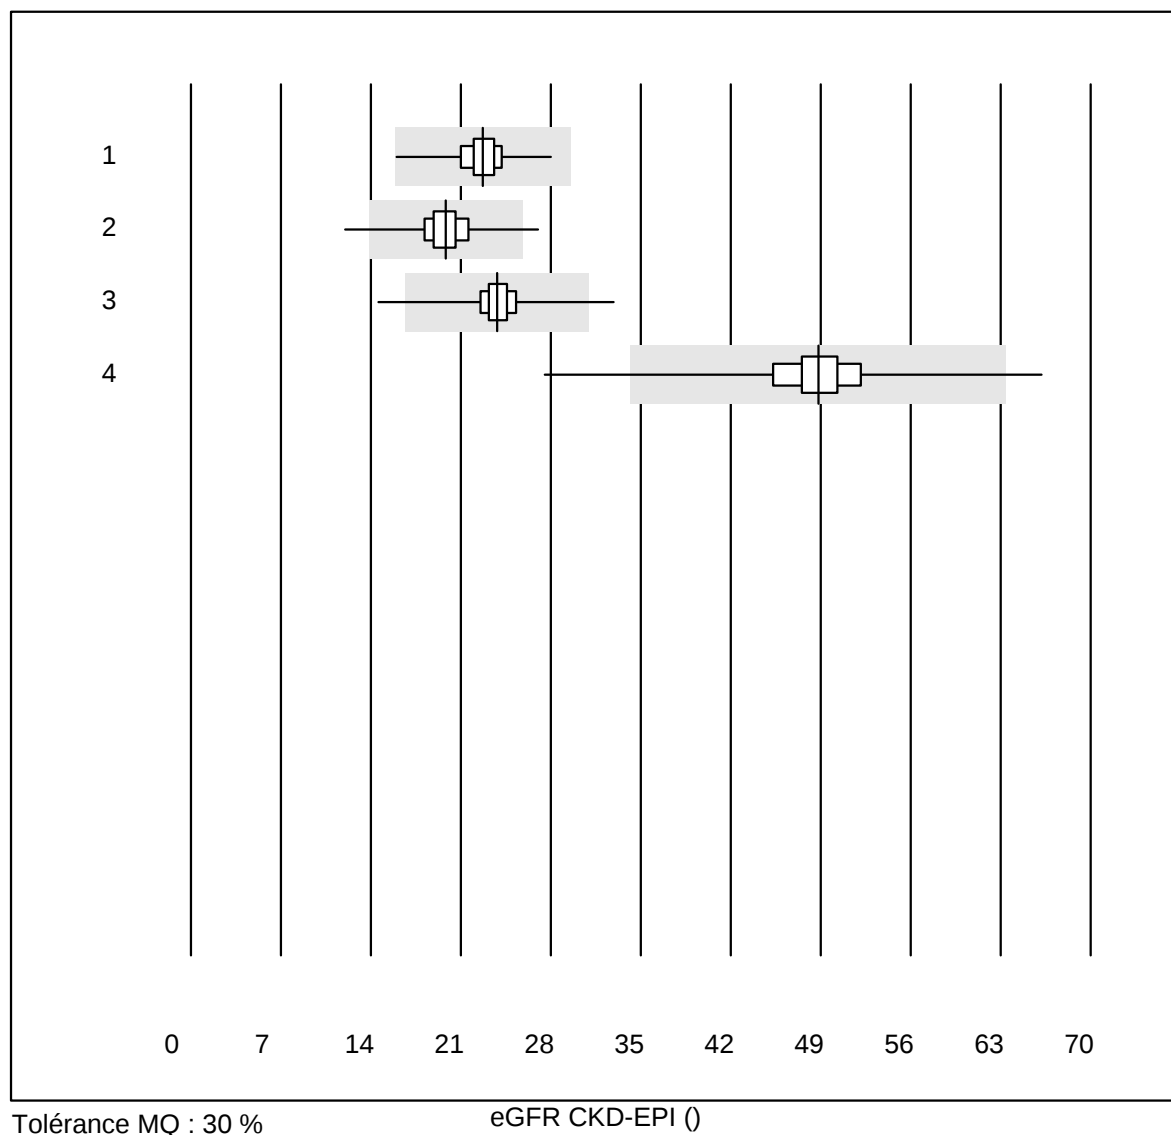


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	69	92.8	0.0	7.2	23	7.6	e
2	Reflotron	227	93.8	0.9	5.3	20	7.5	e
3	Fuji Dri-Chem	354	93.8	1.1	5.1	24	6.8	e
4	Spotchem/Ready	161	92.6	1.2	6.2	49	7.2	e

eGFR Cockcroft-Gault

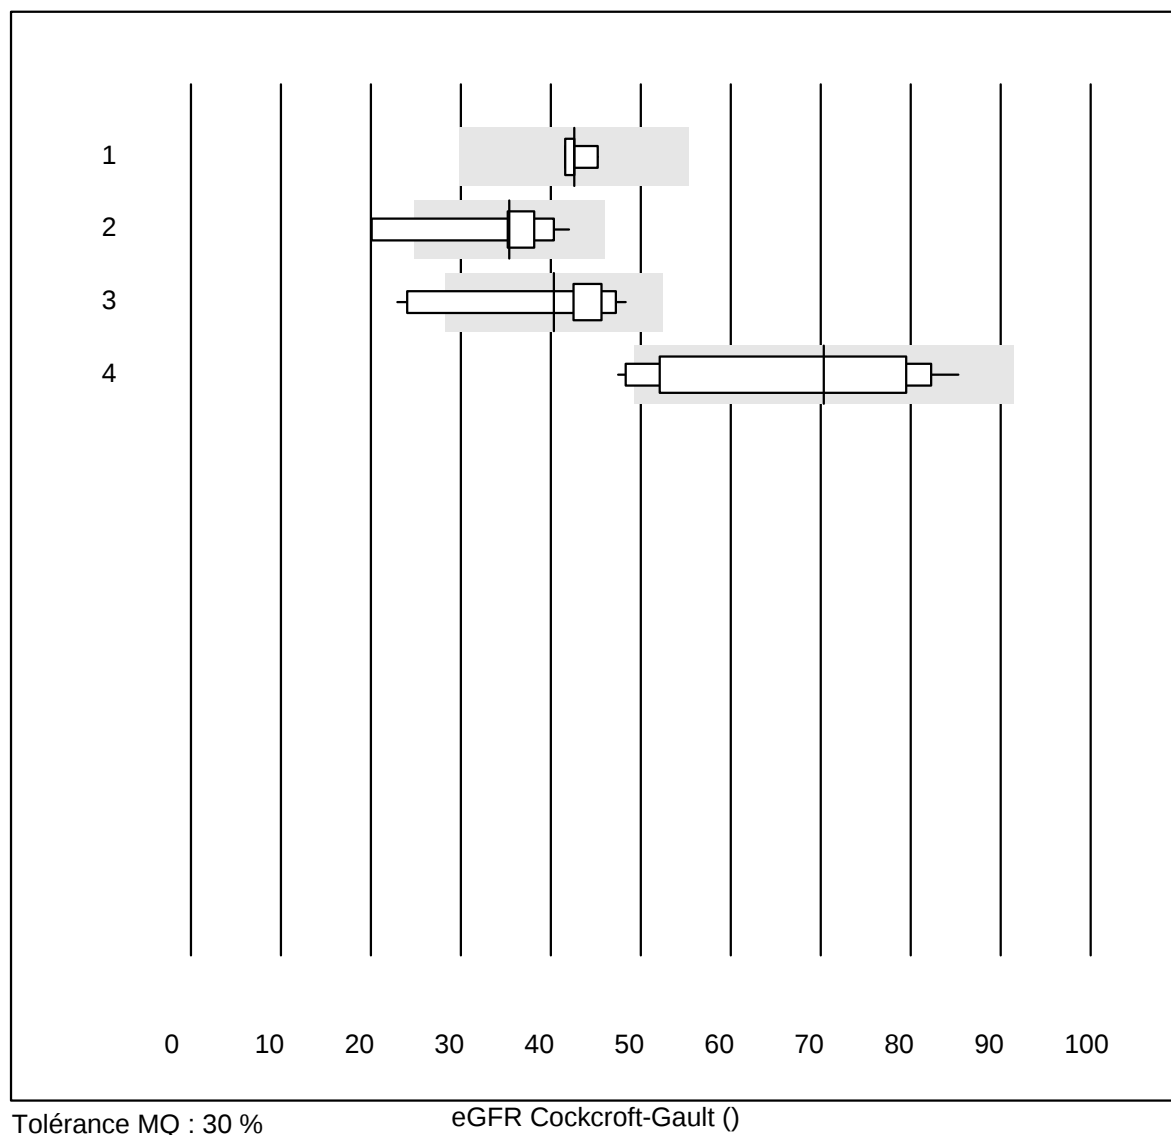


eGFR MDRD

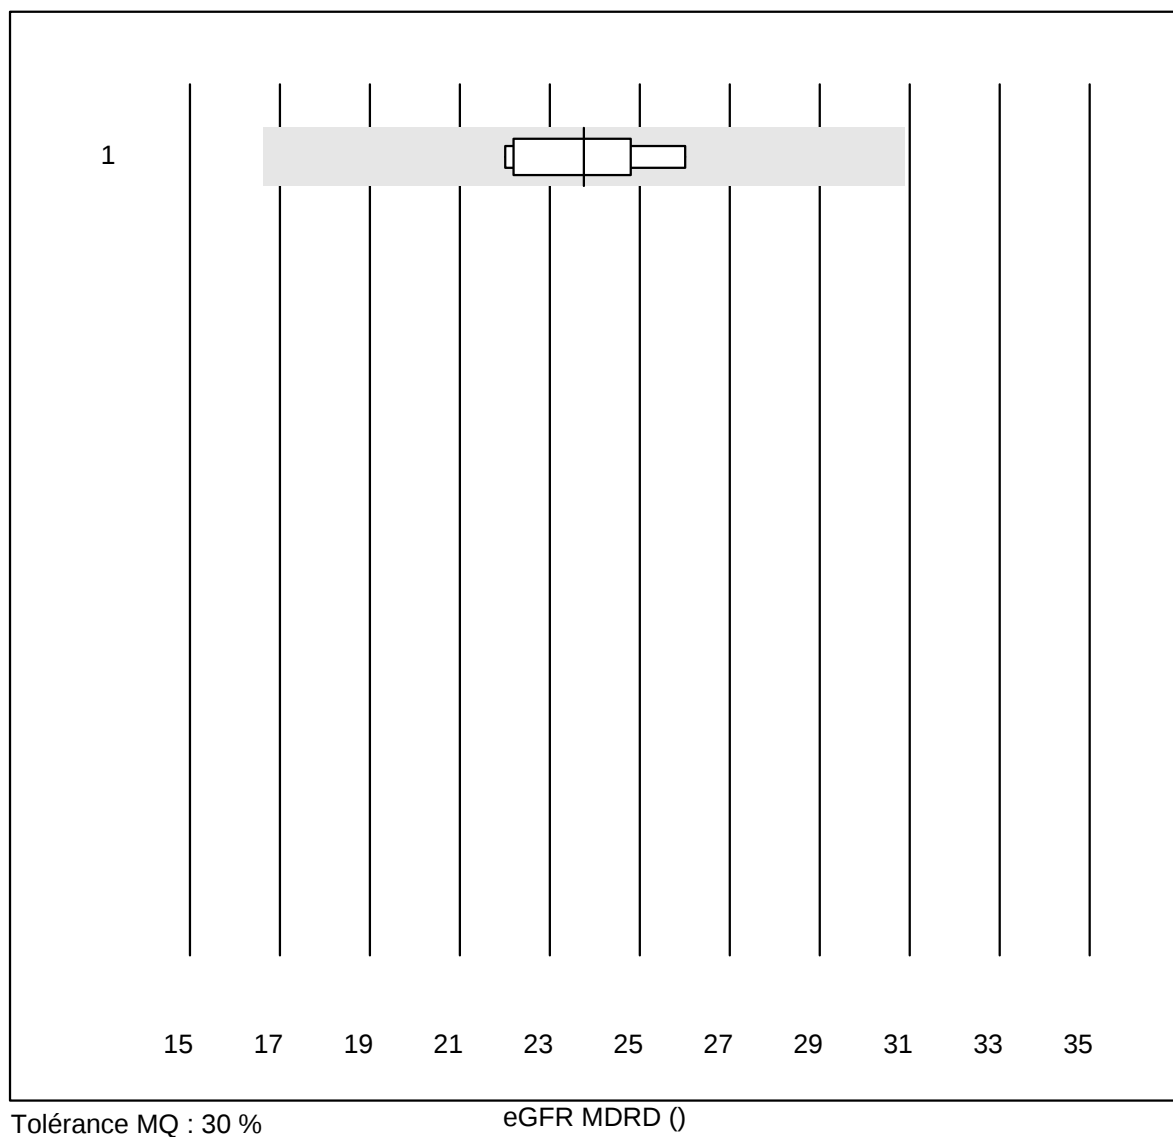

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Fuji Dri-Chem	6	100.0	0.0	0.0	24	6.4	e

LDH

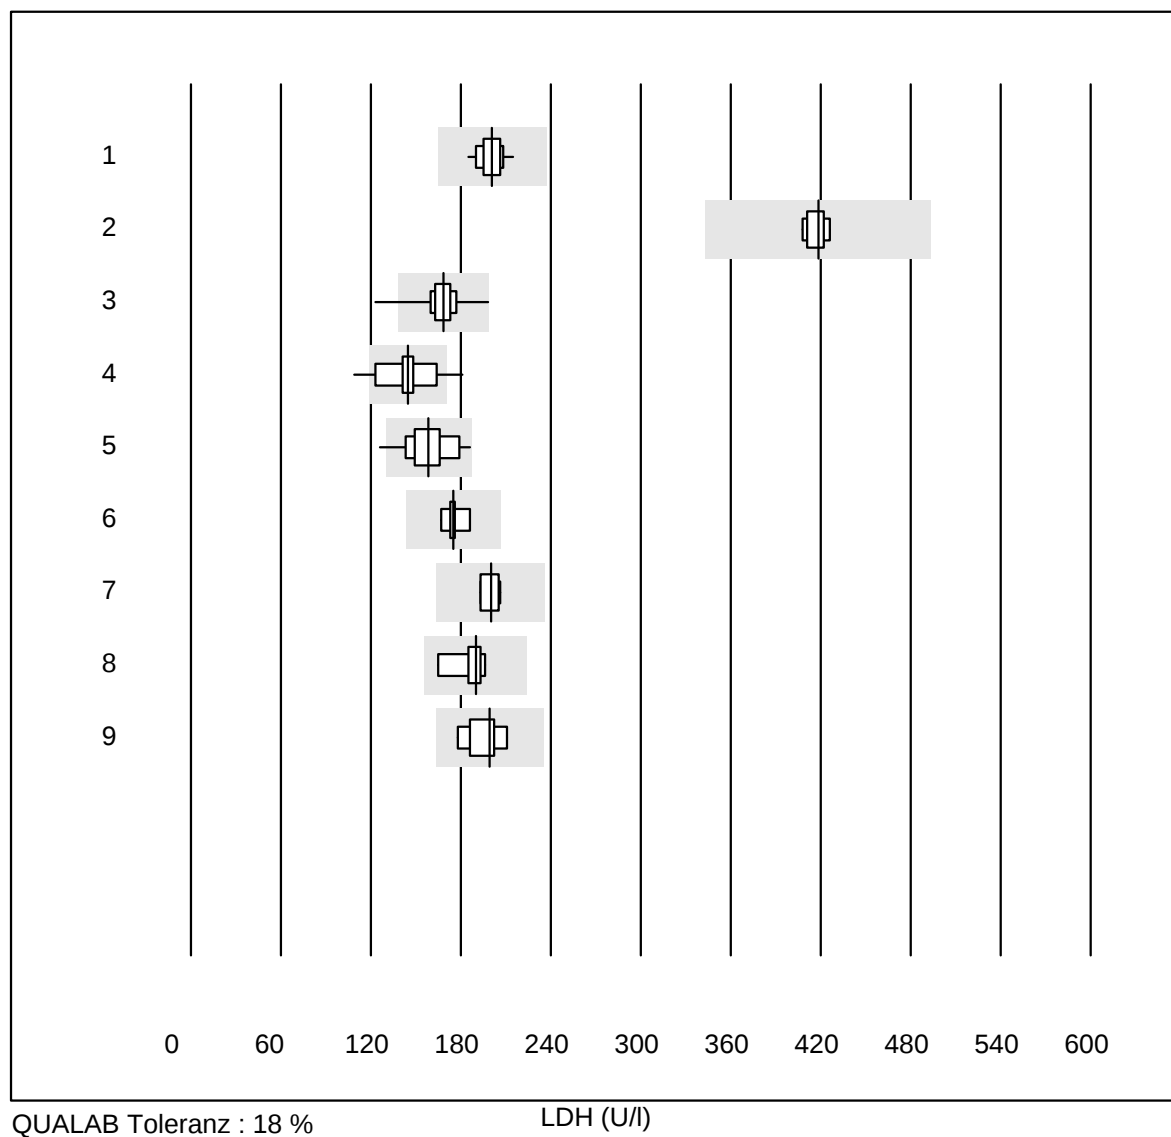


QUALAB Toleranz : 18 %

LDH (U/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	IFCC	36	100.0	0.0	0.0	201	3.7	e
2	Cobas	8	100.0	0.0	0.0	419	1.6	e
3	Fuji Dri-Chem	139	99.3	0.7	0.0	168	5.3	e
4	Spotchem/Ready	13	76.9	15.4	7.7	145	12.3	e*
5	Spotchem D-Concept	48	97.9	2.1	0.0	158	8.6	e
6	Piccolo	7	100.0	0.0	0.0	175	3.2	e
7	Abx Mira	4	100.0	0.0	0.0	200	3.4	e
8	Hitachi S40/M40	8	100.0	0.0	0.0	190	5.3	e
9	Autolysier/DiaSys	9	100.0	0.0	0.0	199	5.7	e

Magnésium

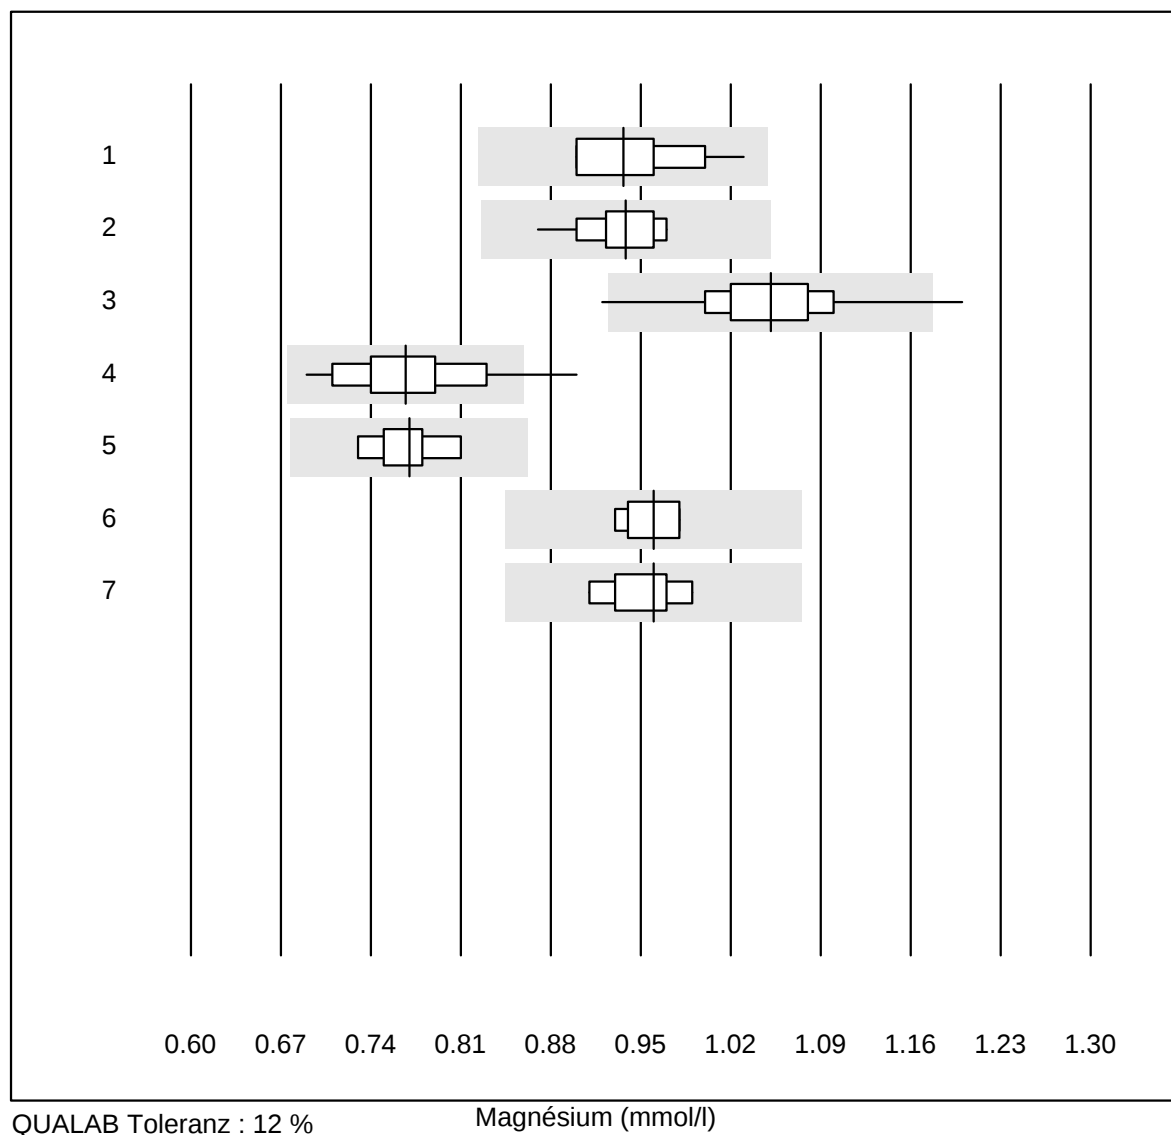

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	16	100.0	0.0	0.0	0.94	4.4	e
2	Cobas	16	100.0	0.0	0.0	0.94	3.0	e
3	Fuji Dri-Chem	106	95.3	3.8	0.9	1.05	4.7	e
4	Spotchem D-Concept	44	97.7	2.3	0.0	0.77	6.1	e
5	Spotchem/Ready	5	100.0	0.0	0.0	0.77	3.9	e*
6	Beckman	7	100.0	0.0	0.0	0.96	2.0	e
7	Piccolo	9	100.0	0.0	0.0	0.96	2.7	e

Sodium

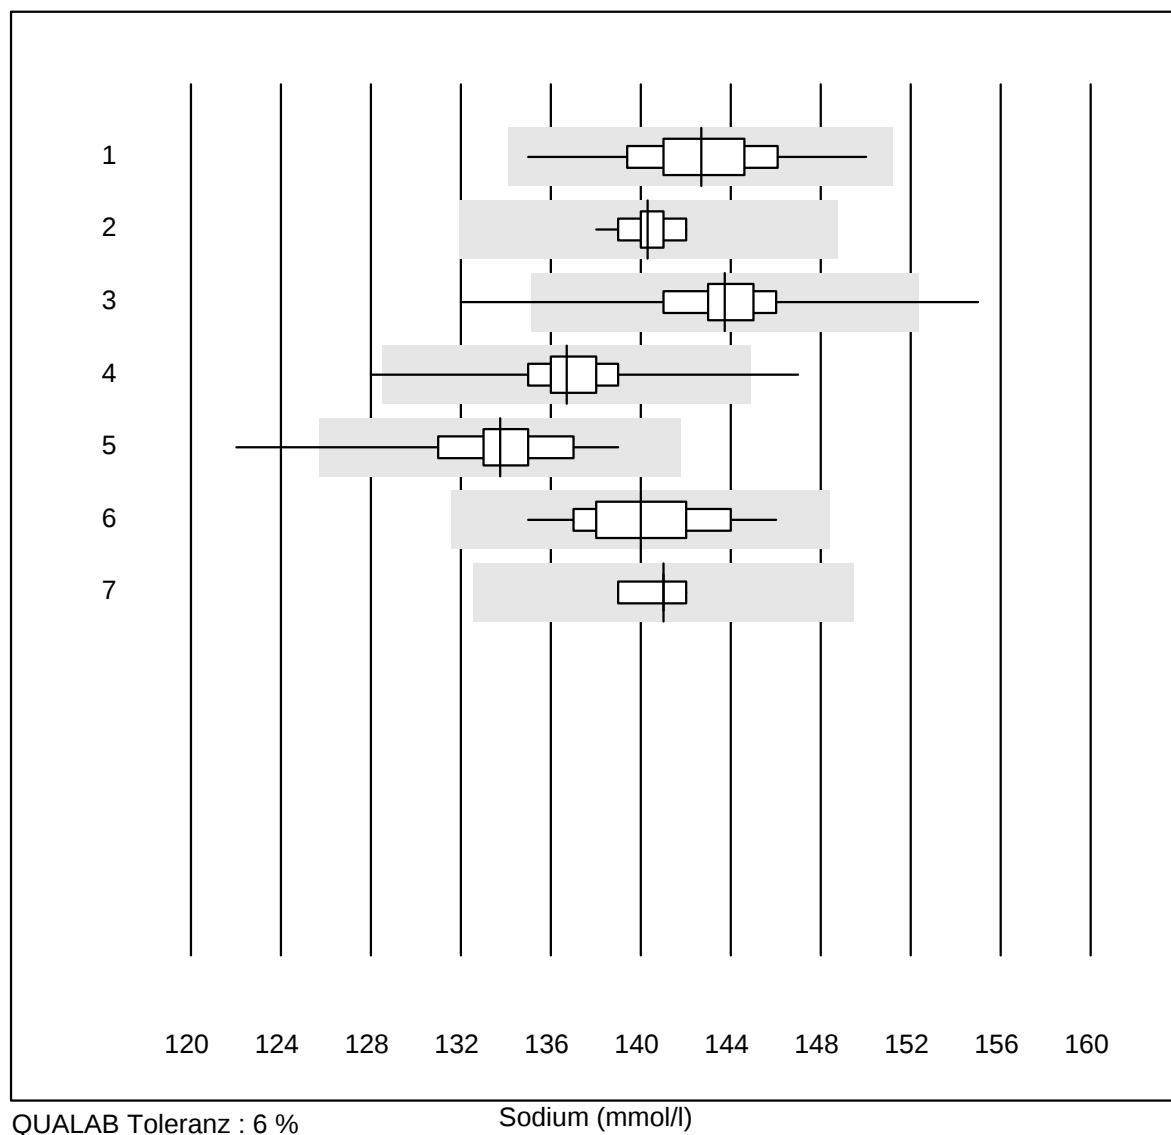


QUALAB Toleranz : 6 %

Sodium (mmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ISE	41	100.0	0.0	0.0	143	2.1	e
2	Cobas	22	100.0	0.0	0.0	140	0.8	e
3	Fuji Dri-Chem	819	99.0	0.4	0.6	144	1.5	e
4	Spotchem D-Concept	306	99.3	0.7	0.0	137	1.5	e
5	Spotchem EL-SE 1520	70	98.6	1.4	0.0	134	1.9	e
6	Piccolo	38	100.0	0.0	0.0	140	1.8	e
7	iStat Chem8	6	100.0	0.0	0.0	141	0.7	e

Phosphates

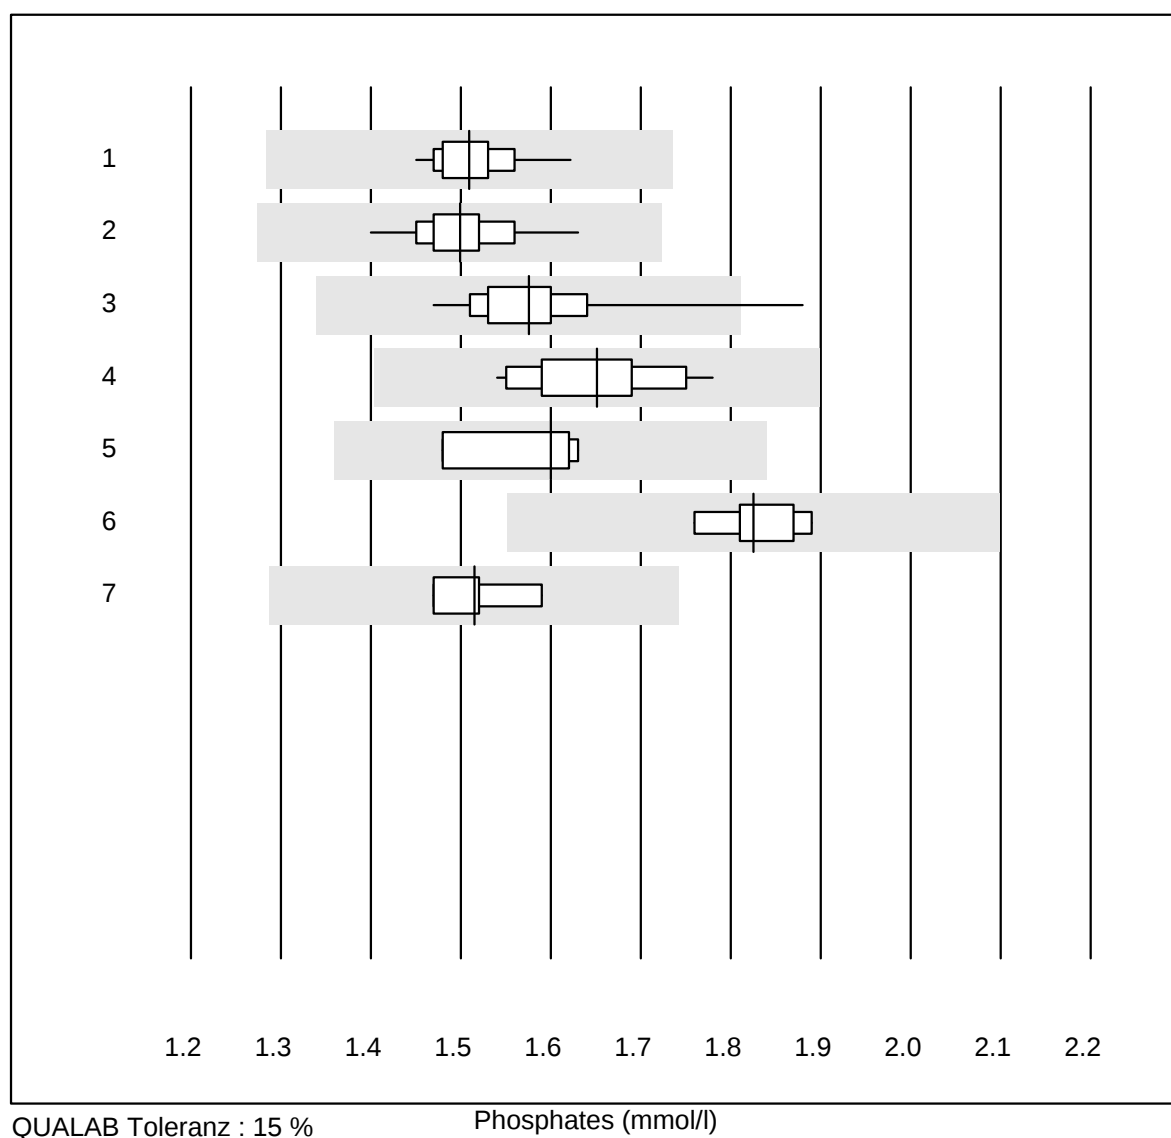


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	22	100.0	0.0	0.0	1.5	2.7	e
2	Cobas	18	100.0	0.0	0.0	1.5	3.3	e
3	Fuji Dri-Chem	80	98.7	1.3	0.0	1.6	4.4	e
4	Spotchem D-Concept	21	95.2	0.0	4.8	1.7	4.4	e
5	Spotchem/Ready	4	100.0	0.0	0.0	1.6	4.3	e*
6	Piccolo	6	100.0	0.0	0.0	1.8	2.5	e
7	Hitachi S40/M40	4	100.0	0.0	0.0	1.5	3.3	e

Protéine

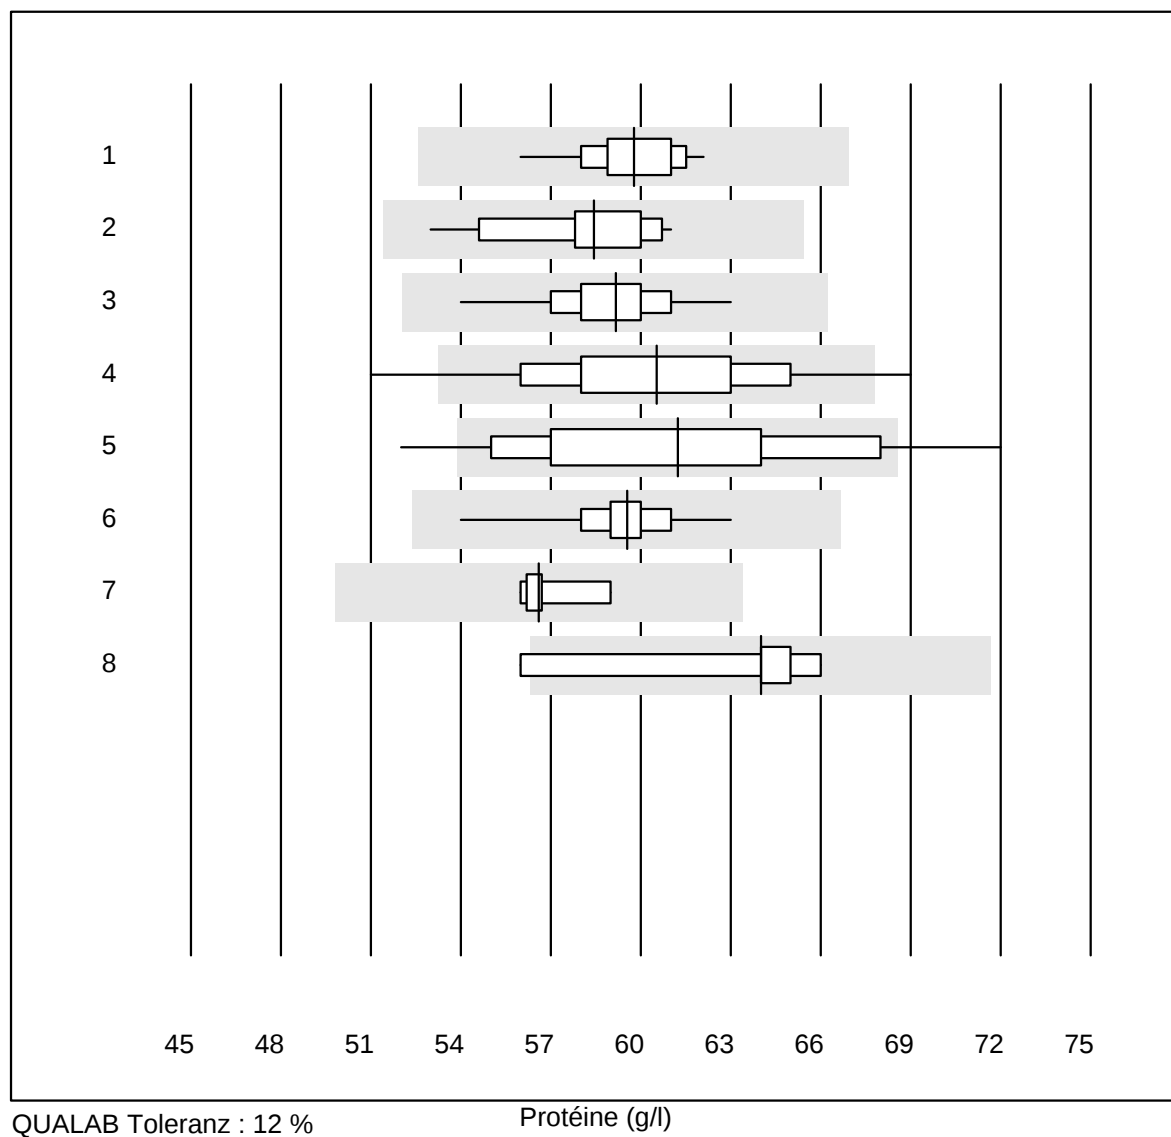


Transaminase GOT/AST

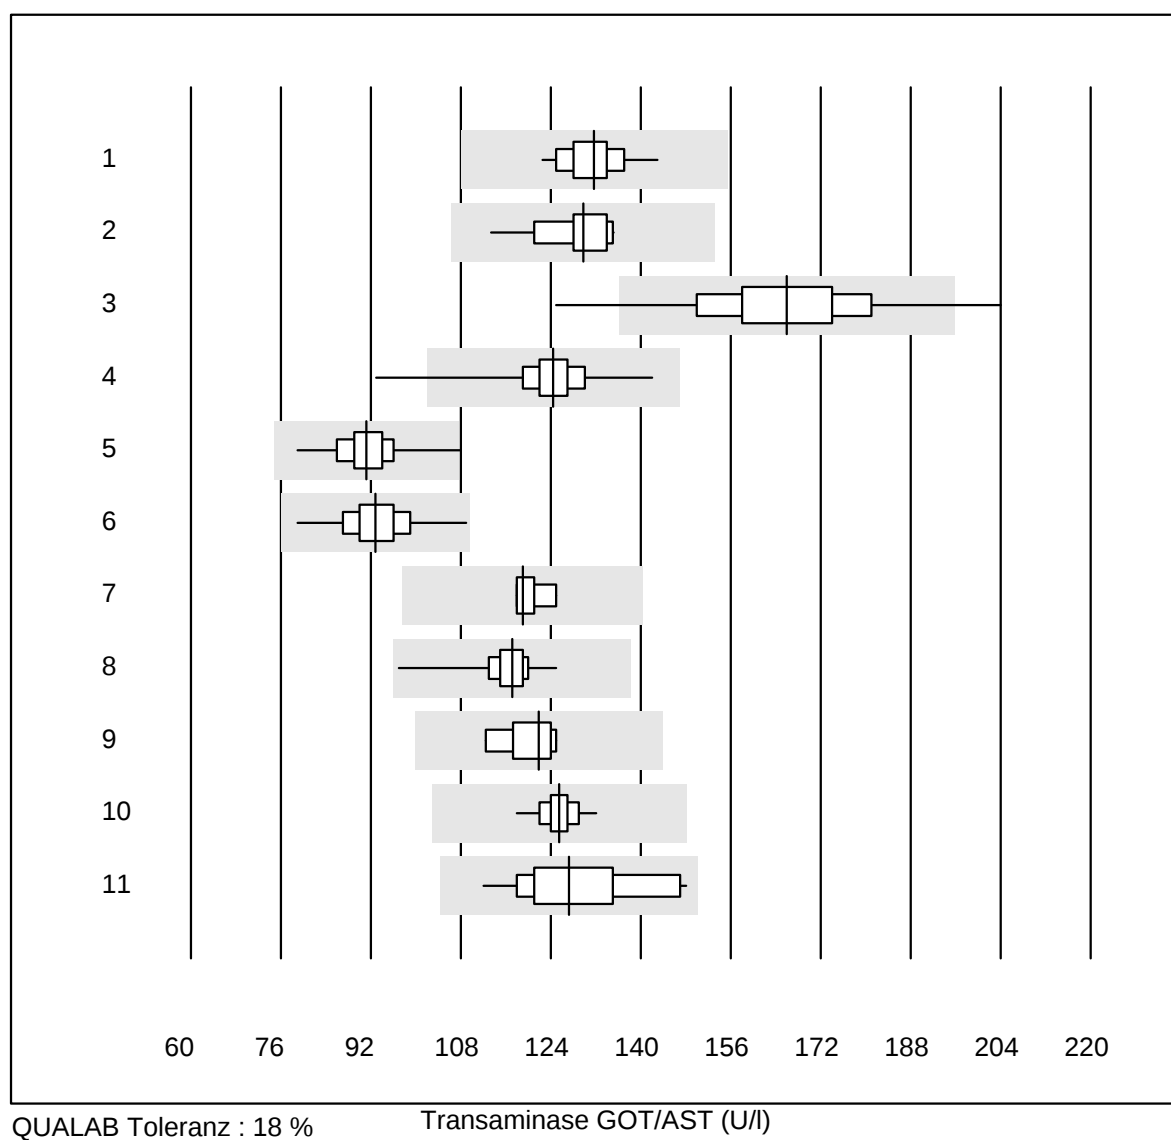


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC avec PP	28	96.4	0.0	3.6	132	3.5	e
2 Cobas	18	100.0	0.0	0.0	130	4.6	e
3 Reflotron	607	94.7	3.0	2.3	166	7.6	e
4 Fuji Dri-Chem	897	99.6	0.3	0.1	124	3.9	e
5 Spotchem/Ready	86	98.8	1.2	0.0	91	4.8	e
6 Spotchem D-Concept	346	99.1	0.0	0.9	93	5.1	e
7 IFCC sens PP	5	100.0	0.0	0.0	119	2.5	e
8 Piccolo	58	98.3	0.0	1.7	117	3.5	e
9 Abx Mira	8	87.5	0.0	12.5	122	3.8	e
10 Hitachi S40/M40	16	100.0	0.0	0.0	125	2.6	e
11 Autolyser/DiaSys	19	100.0	0.0	0.0	127	7.8	e

Transaminase GPT/ALT

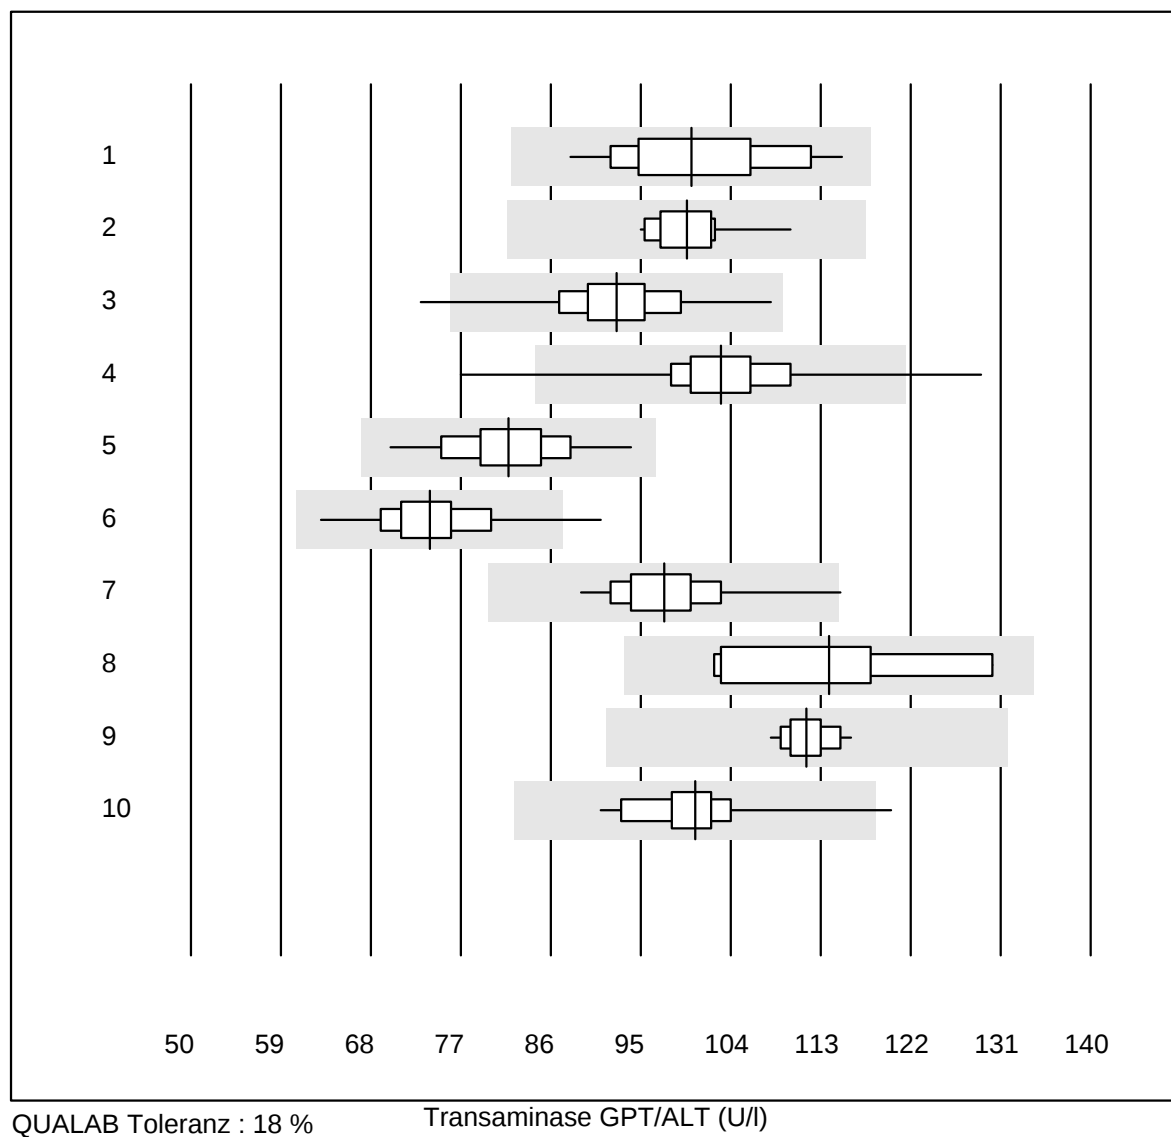

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC avec PP	26	100.0	0.0	0.0	100	7.6	e
2 Cobas	23	100.0	0.0	0.0	100	3.4	e
3 Reflotron	628	98.4	0.8	0.8	93	5.6	e
4 Fuji Dri-Chem	908	99.0	0.6	0.4	103	5.0	e
5 Spotchem/Ready	89	97.8	0.0	2.2	82	5.9	e
6 Spotchem D-Concept	350	98.3	1.1	0.6	74	5.9	e
7 Piccolo	57	94.7	1.8	3.5	97	4.8	e
8 Abx Mira	7	100.0	0.0	0.0	114	8.9	e*
9 Hitachi S40/M40	17	100.0	0.0	0.0	112	2.0	e
10 Autolyser/DiaSys	18	94.4	5.6	0.0	100	5.9	e

Triglycérides

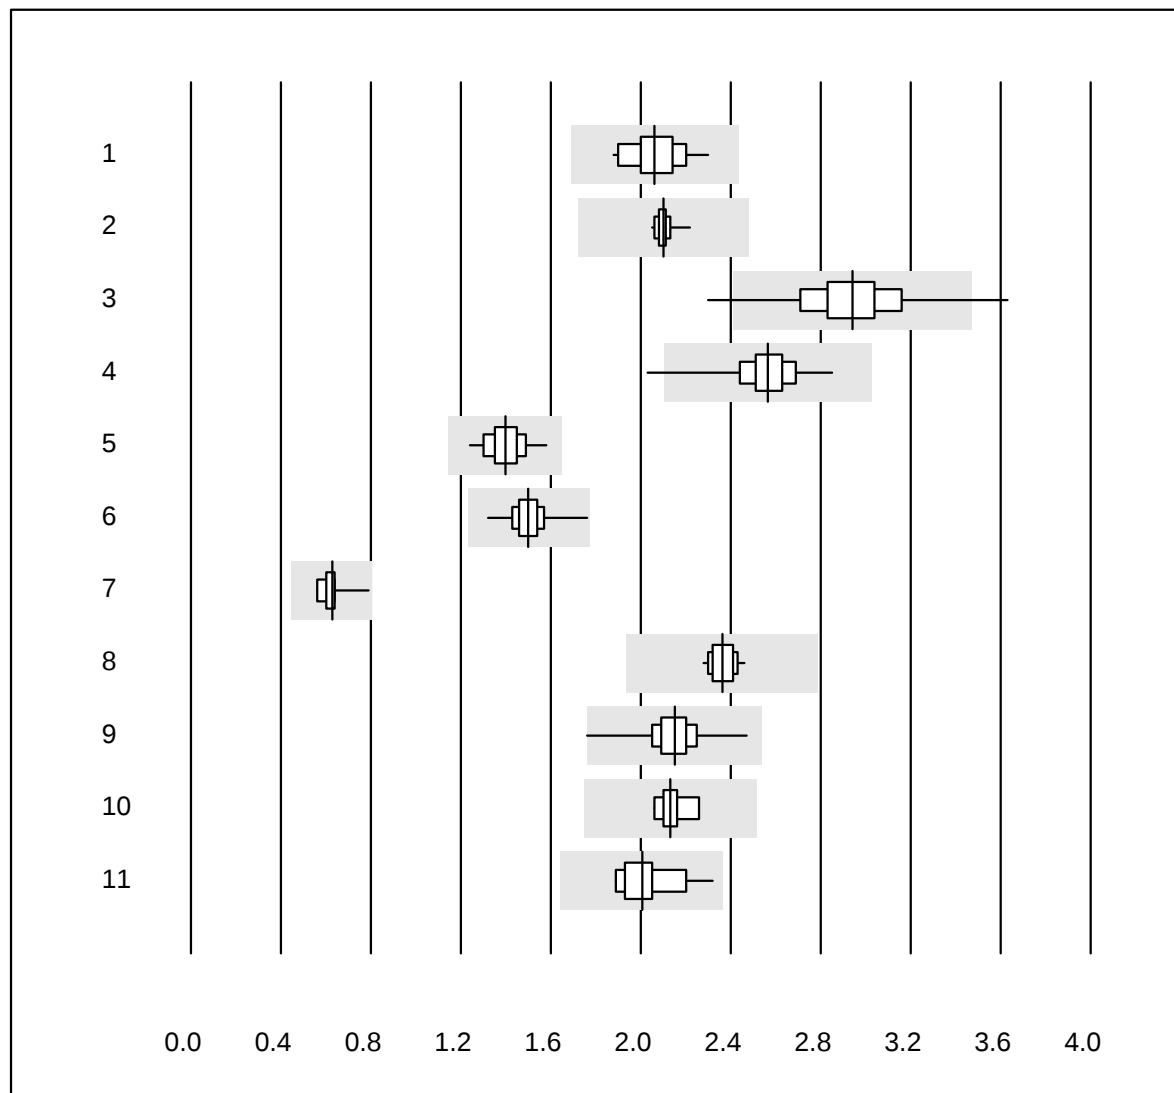


QUALAB Toleranz : 18 %
(< 1.00: +/- 0.18 mmol/l)

Triglycérides (mmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	28	96.4	0.0	3.6	2.06	5.3	e
2	Cobas	22	100.0	0.0	0.0	2.10	1.7	e
3	Reflotron	314	95.2	1.9	2.9	2.94	6.5	e
4	Fuji Dri-Chem	792	98.8	0.3	0.9	2.57	3.9	e
5	Spotchem/Ready	72	95.8	0.0	4.2	1.40	5.1	e
6	Spotchem D-Concept	303	99.3	0.0	0.7	1.50	3.9	e
7	Hitachi S40/M40	10	100.0	0.0	0.0	0.63	9.8	e*
8	Piccolo	19	100.0	0.0	0.0	2.36	2.1	e
9	Cholestech LDX	314	99.7	0.3	0.0	2.15	4.1	e
10	Abx Mira	7	85.7	0.0	14.3	2.13	3.2	e
11	Autolyser/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	2.01	5.5	e

Lithium

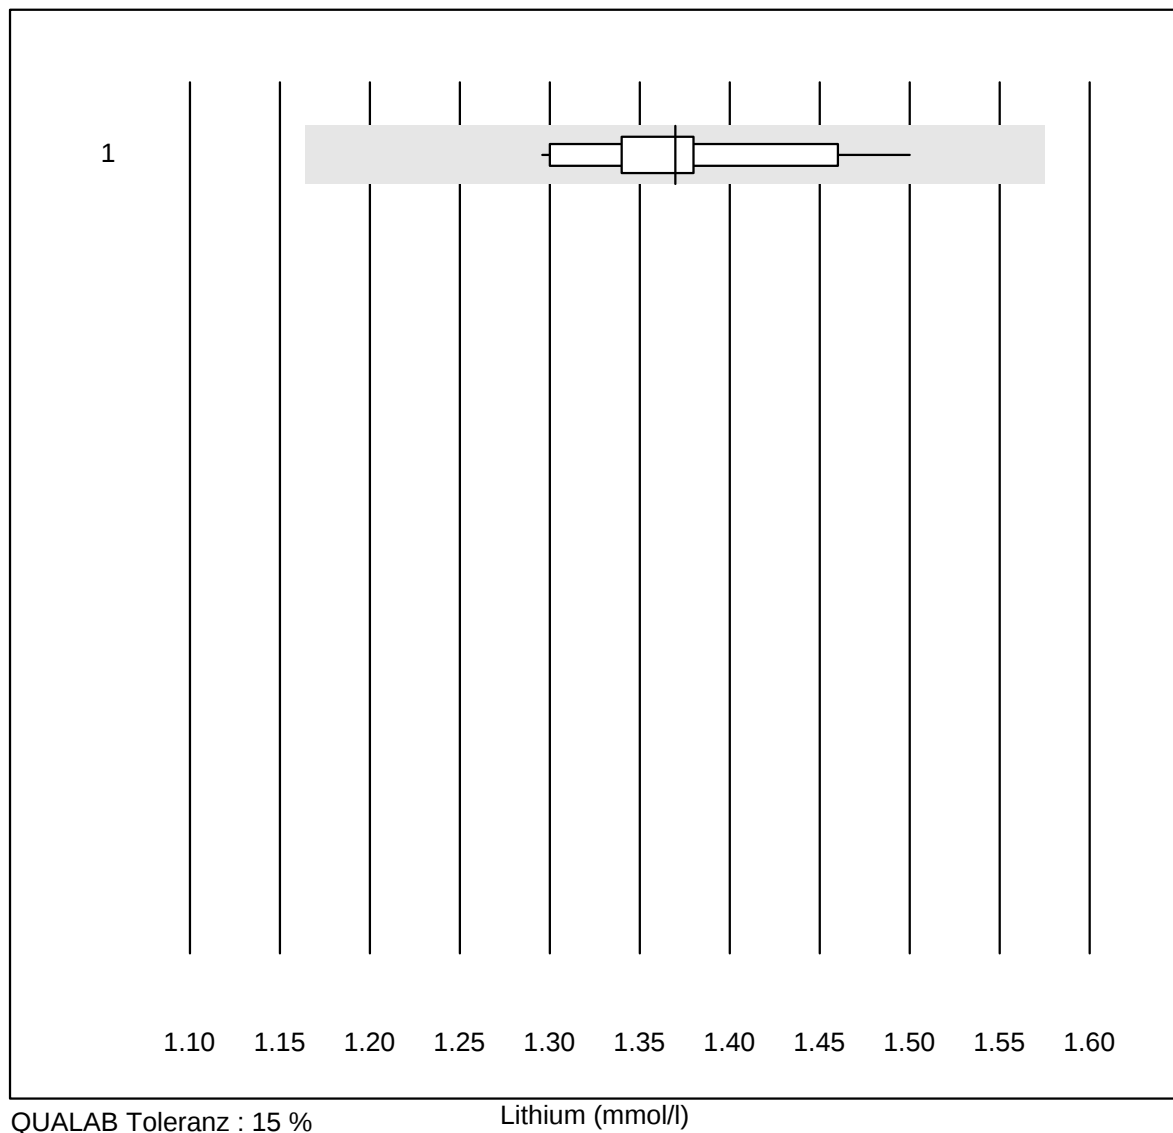


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	17	100.0	0.0	0.0	1.37	3.9	e

Laktat

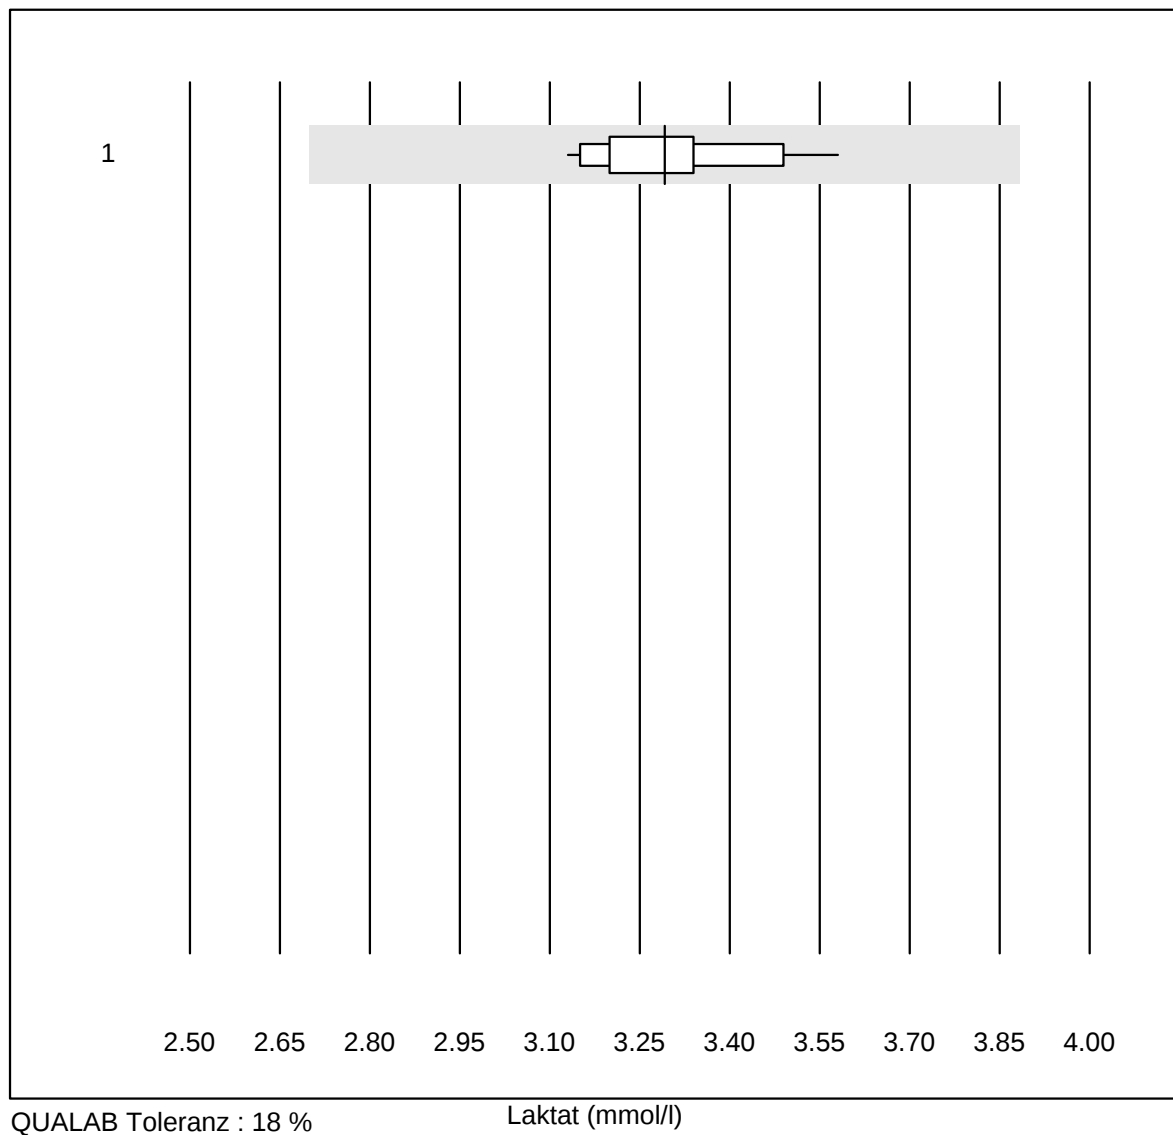


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	14	100.0	0.0	0.0	3.29	4.0	e

HbA1c échantillon A

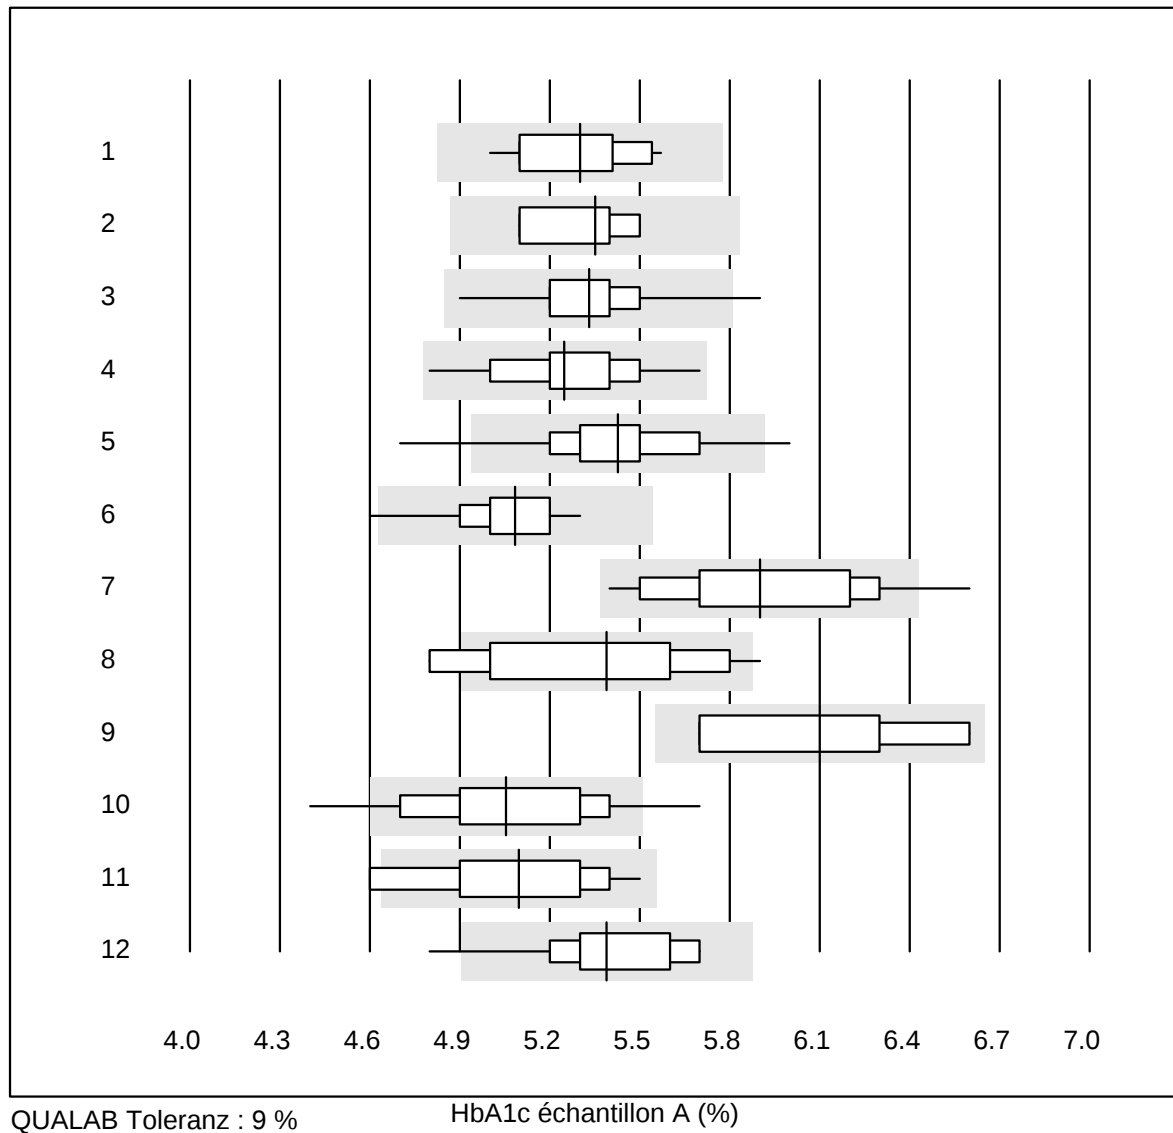

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Roche, Cobas	16	93.7	0.0	6.3	5.3	3.4	e
2	HPLC	8	100.0	0.0	0.0	5.4	2.7	e
3	Afinion	575	99.5	0.2	0.3	5.3	2.5	e
4	Cobas b101	126	99.2	0.0	0.8	5.2	3.3	e
5	DCA2000/Vantage	150	97.4	1.3	1.3	5.4	3.5	e
6	Celltac chemi	19	94.7	5.3	0.0	5.1	3.1	e
7	NycoCard	32	87.5	9.4	3.1	5.9	5.8	e
8	Eurolyser	10	80.0	20.0	0.0	5.4	6.7	a
9	Hemocue HbA1c 501	4	100.0	0.0	0.0	6.1	6.1	a
10	A1c Now	204	85.8	9.3	4.9	5.1	5.8	e
11	AFIAS	33	84.9	12.1	3.0	5.1	5.7	e
12	Andere	15	93.3	6.7	0.0	5.4	4.1	a
13	Spinit	10	90.0	10.0	0.0	5.4	4.4	a


HbA1c échantillon B

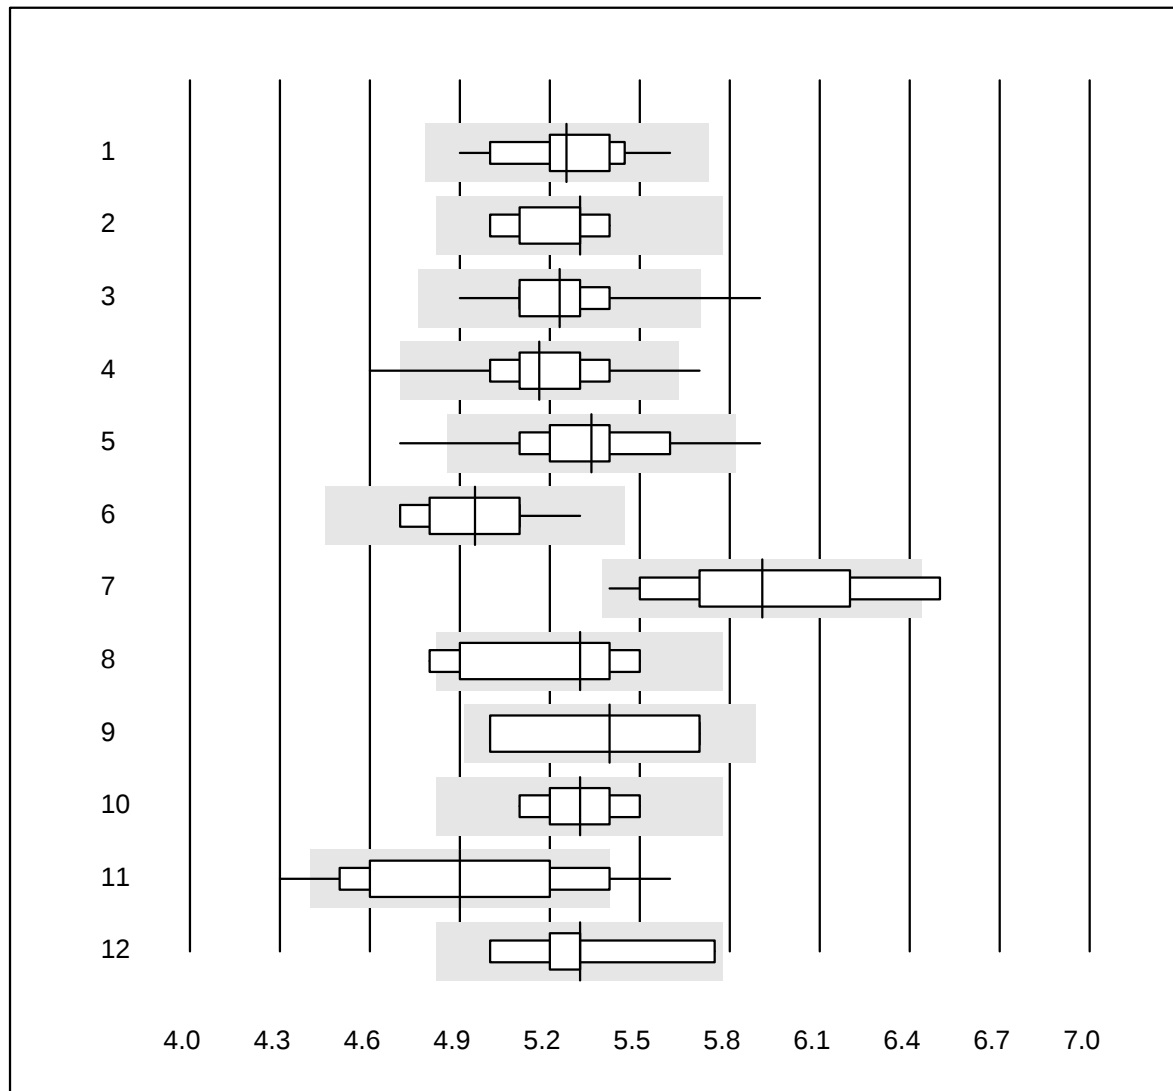


QUALAB Toleranz : 9 %
(< 5.0: +/- 0.5 %)

HbA1c échantillon B (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Roche, Cobas	15	100.0	0.0	0.0	5.3	3.4	e
2	HPLC	8	100.0	0.0	0.0	5.3	2.4	a
3	Afinion	788	99.1	0.6	0.3	5.2	2.6	e
4	Cobas b101	138	95.7	3.6	0.7	5.2	3.7	e
5	DCA2000/Vantage	217	98.6	0.9	0.5	5.3	3.3	e
6	Celltac chemi	14	100.0	0.0	0.0	5.0	3.9	e
7	Nycocard	13	69.2	15.4	15.4	5.9	6.3	e*
8	Eurolyser	7	85.7	14.3	0.0	5.3	5.2	a
9	Hemocue HbA1c 501	4	75.0	0.0	25.0	5.4	7.2	e*
10	A1c Now	11	81.8	0.0	18.2	5.3	2.7	a
11	AFIAS	48	72.9	20.8	6.3	4.9	7.2	e
12	Spinit	8	100.0	0.0	0.0	5.3	4.0	a
13	Andere	13	100.0	0.0	0.0	5.3	5.2	e*

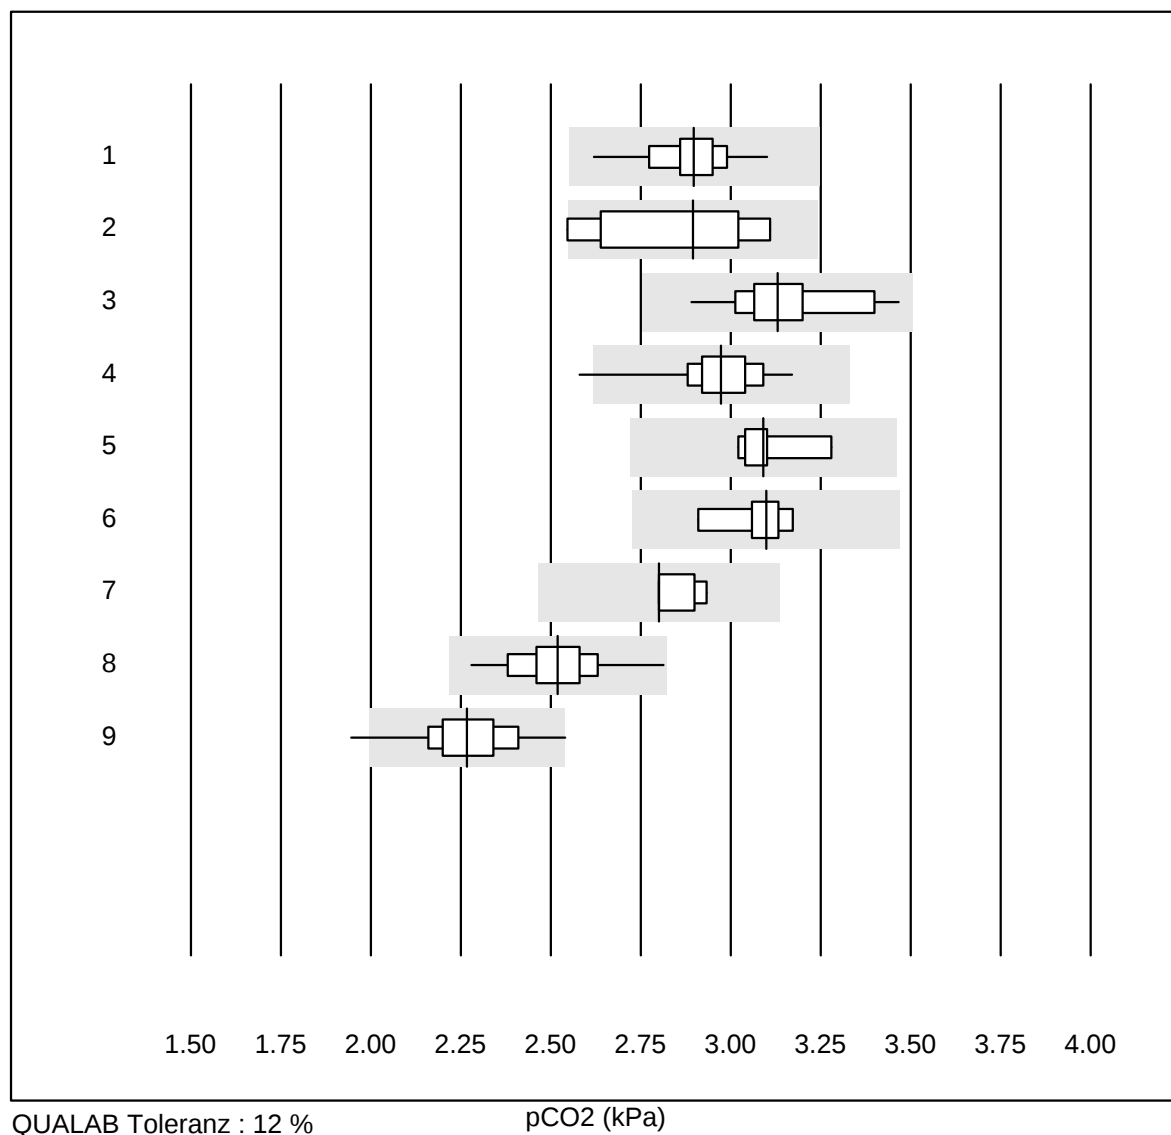
pCO₂

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL700/800	86	100.0	0.0	0.0	2.90	2.9	e
2	ABL80 FLEX	8	87.5	12.5	0.0	2.90	7.3	e*
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	14	100.0	0.0	0.0	3.13	4.6	e
4	ABL90 FLEX / PLUS	75	96.0	1.3	2.7	2.97	3.3	e
5	Cobas b 123	8	100.0	0.0	0.0	3.09	2.6	e
6	Cobas b 221	7	100.0	0.0	0.0	3.10	2.7	e
7	GEM	5	100.0	0.0	0.0	2.80	2.3	e
8	iStat	44	97.7	0.0	2.3	2.52	4.2	e
9	EPOC	42	92.8	4.8	2.4	2.27	5.4	e

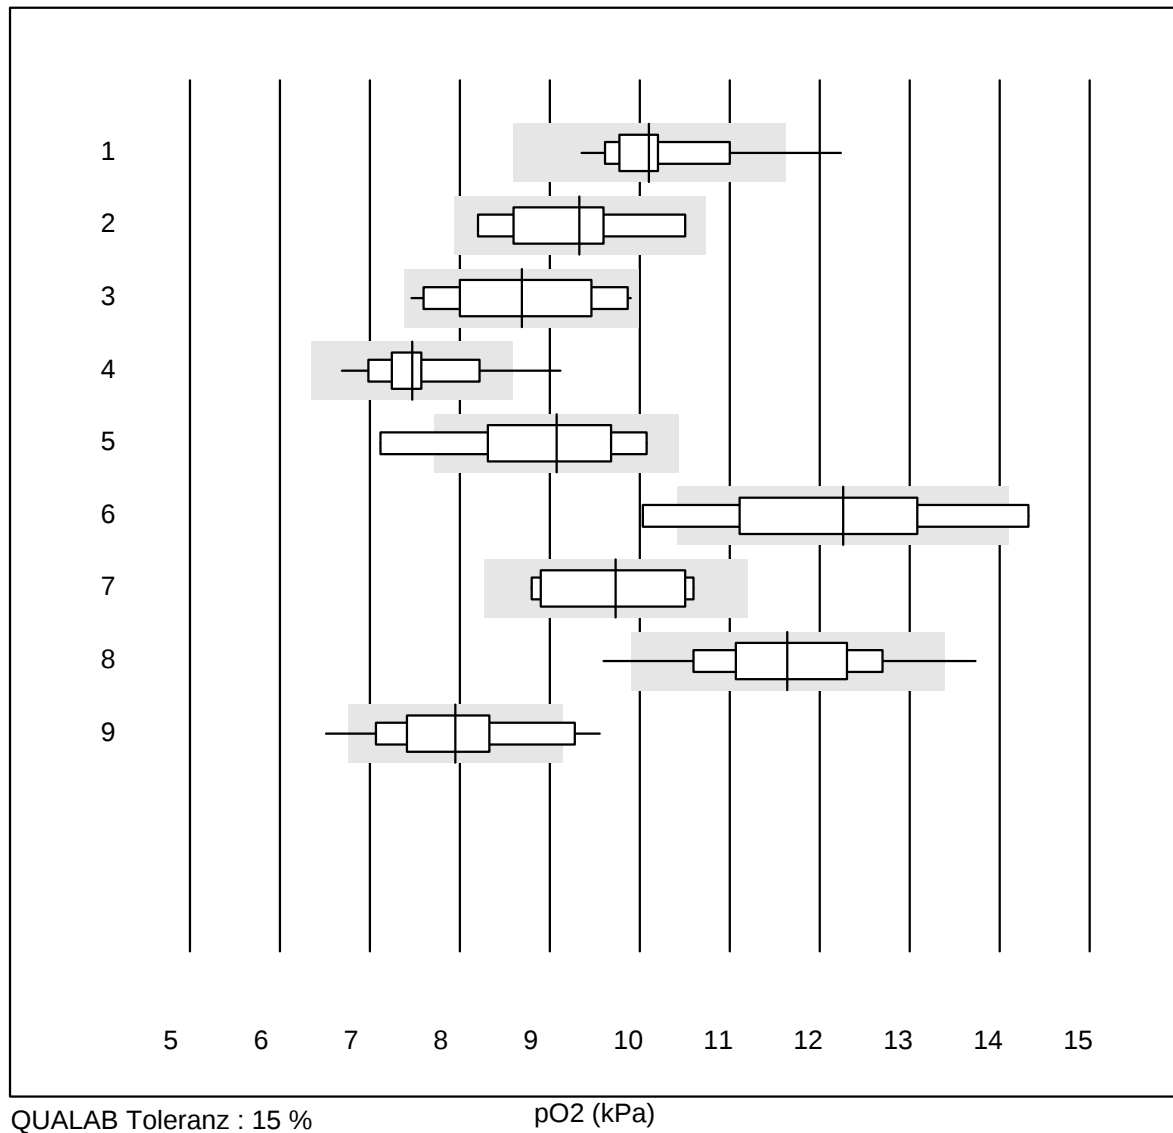pO₂

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL700/800	85	91.7	2.4	5.9	10.10	5.5	e
2	ABL80 FLEX	8	100.0	0.0	0.0	9.33	8.0	e*
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	14	100.0	0.0	0.0	8.69	10.1	e*
4	ABL90 FLEX / PLUS	75	89.3	4.0	6.7	7.47	6.5	e
5	Cobas b 123	8	75.0	12.5	12.5	9.08	11.1	e*
6	Cobas b 221	7	71.4	28.6	0.0	12.26	11.4	e*
7	GEM	5	100.0	0.0	0.0	9.73	8.8	e*
8	iStat	42	83.4	7.1	9.5	11.64	7.4	e
9	EPOC	42	73.8	14.3	11.9	7.95	9.8	e

pH

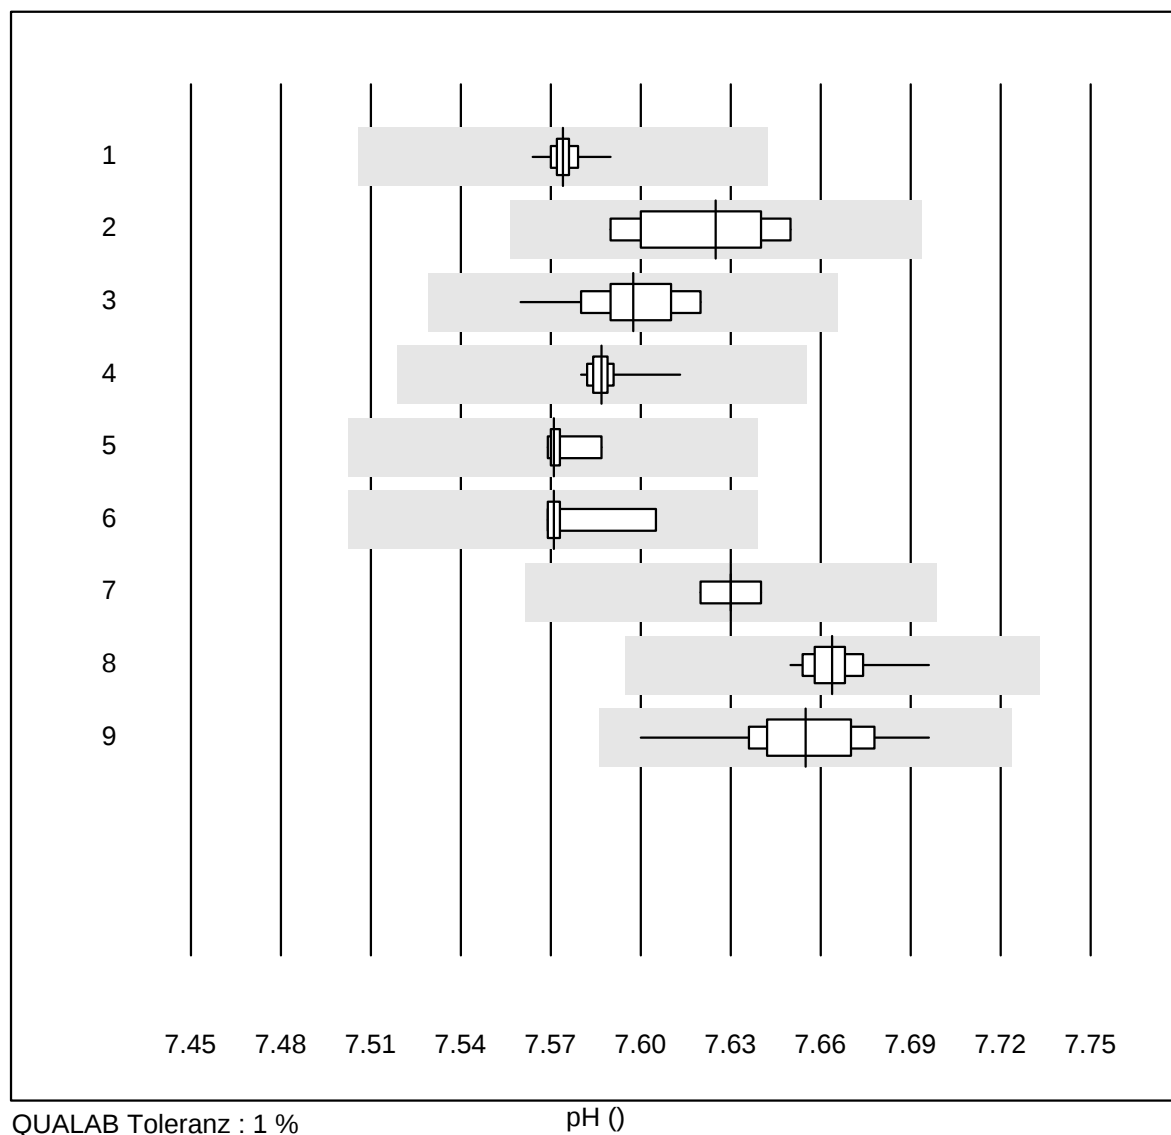


QUALAB Toleranz : 1 %

pH ()

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL700/800	85	100.0	0.0	0.0	7.57	0.1	e
2	ABL80 FLEX	8	100.0	0.0	0.0	7.63	0.3	e
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	13	100.0	0.0	0.0	7.60	0.2	e
4	ABL90 FLEX / PLUS	76	100.0	0.0	0.0	7.59	0.1	e
5	Cobas b 123	8	100.0	0.0	0.0	7.57	0.1	e
6	Cobas b 221	7	100.0	0.0	0.0	7.57	0.2	e
7	GEM	5	100.0	0.0	0.0	7.63	0.1	e
8	iStat	44	100.0	0.0	0.0	7.66	0.1	e
9	EPOC	41	100.0	0.0	0.0	7.66	0.2	e

Glucose GS

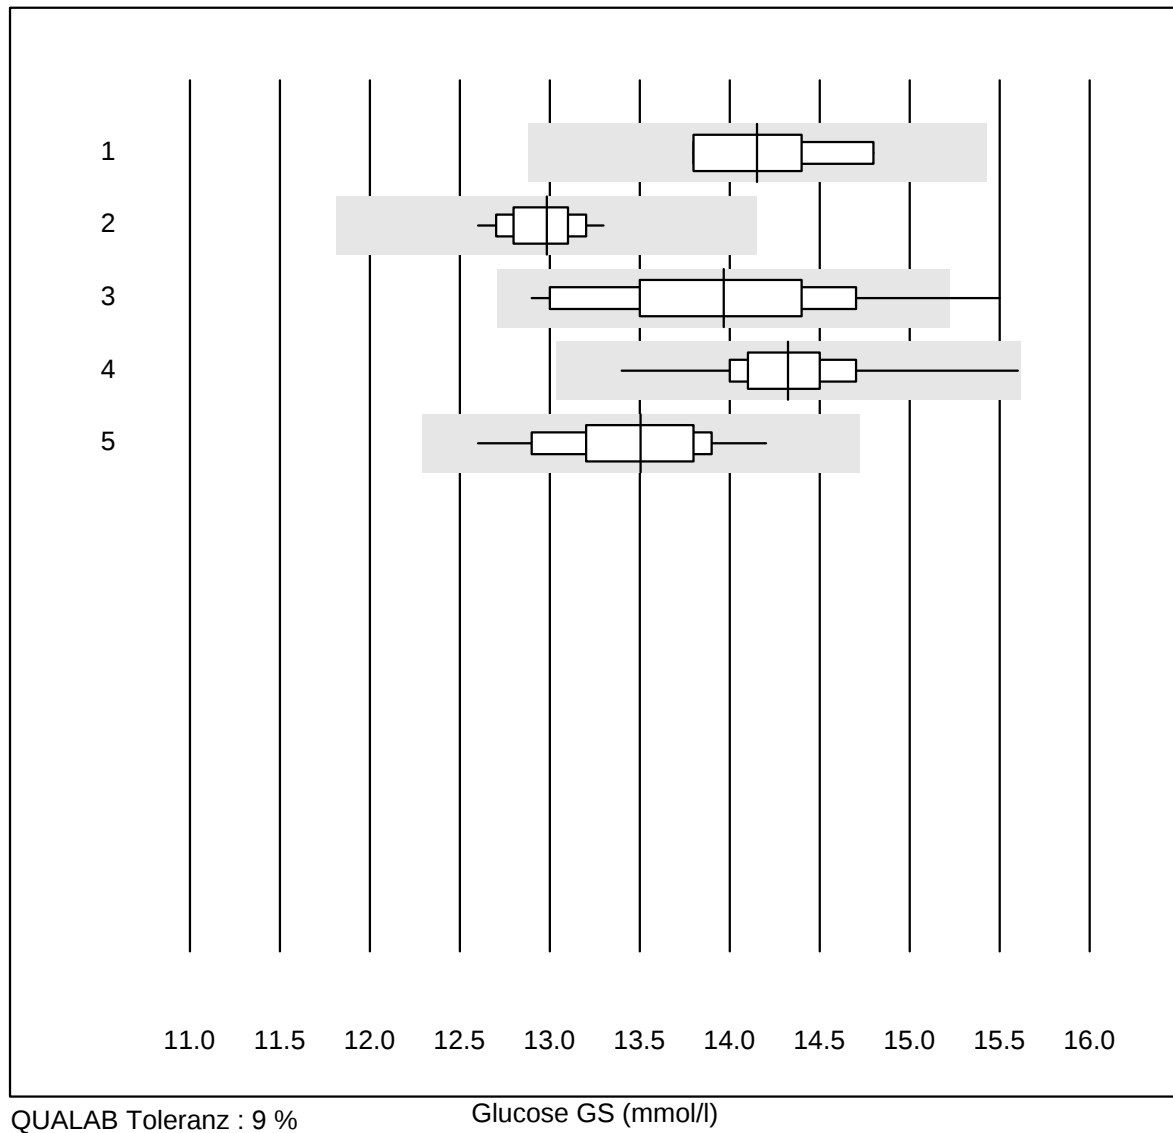


QUALAB Toleranz : 9 %

Glucose GS (mmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas b 123	4	100.0	0.0	0.0	14.2	3.3	e*
2	iStat	12	91.7	0.0	8.3	13.0	1.6	e
3	EPOC	29	89.7	3.4	6.9	14.0	4.5	e
4	ABL700/800	76	100.0	0.0	0.0	14.3	2.2	e
5	ABL90 FLEX / PLUS	74	100.0	0.0	0.0	13.5	2.8	e

Hémoglobine BG

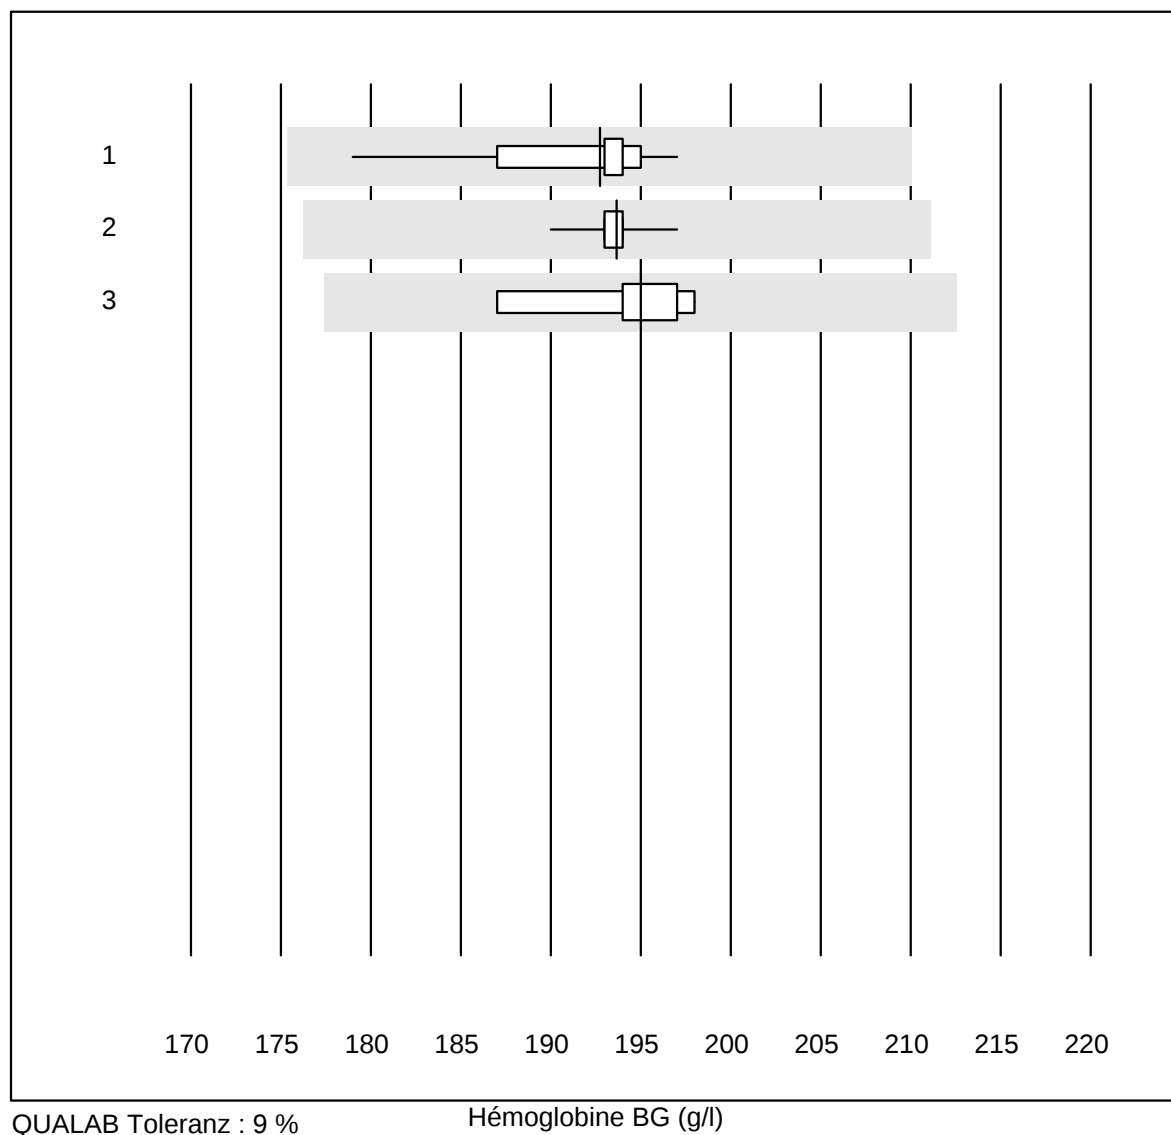


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL700/800	78	100.0	0.0	0.0	192.7	1.9	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	72	98.6	0.0	1.4	193.7	0.5	e
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	10	100.0	0.0	0.0	195.0	1.7	e

Potassium BG

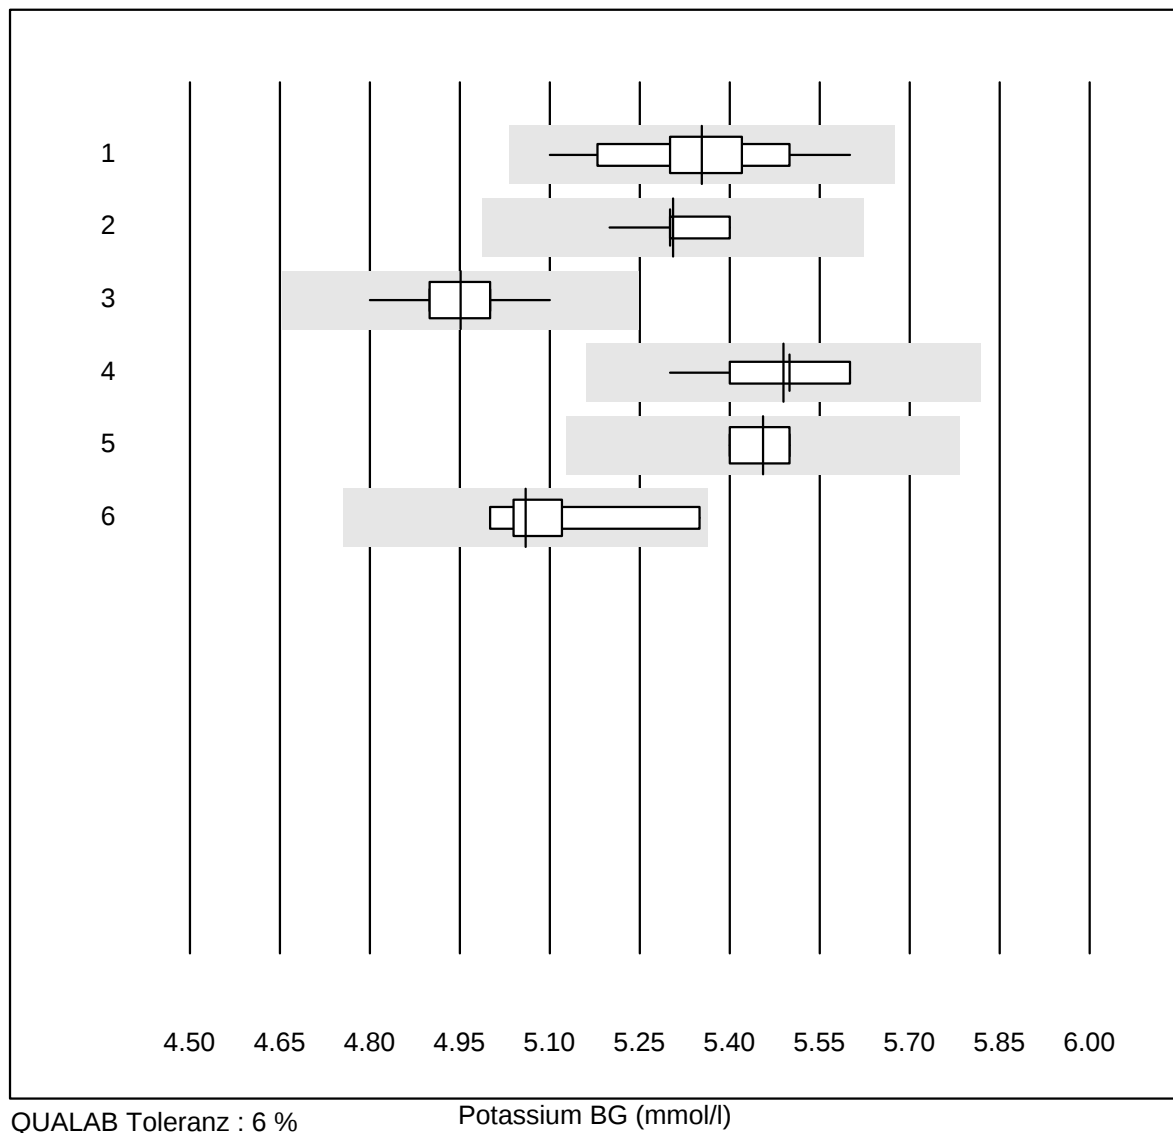


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas b 123	13	100.0	0.0	0.0	5.4	2.4	e
2	iStat	20	95.0	0.0	5.0	5.3	0.8	e
3	EPOC	35	100.0	0.0	0.0	5.0	1.4	e
4	ABL700/800	78	98.7	0.0	1.3	5.5	1.1	e
5	ABL90 FLEX / PLUS	75	98.7	0.0	1.3	5.5	0.9	e
6	ABL80 FLEX CO-OX / O	6	100.0	0.0	0.0	5.1	2.4	e*

Sodium BG

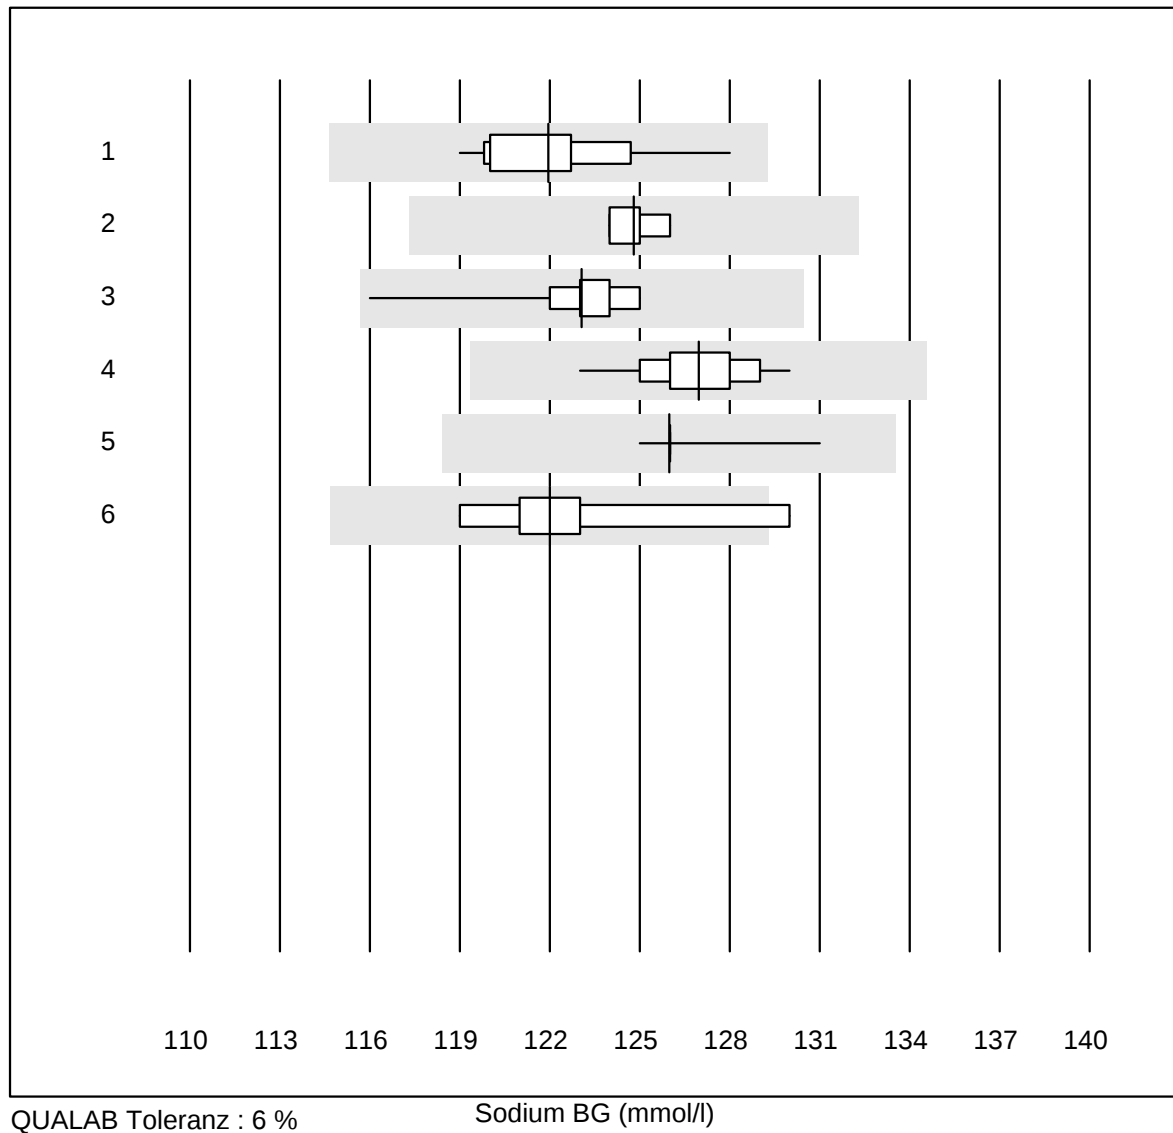

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas b 123	13	100.0	0.0	0.0	122.0	2.0	e
2	iStat	20	95.0	0.0	5.0	124.8	0.5	e
3	EPOC	33	100.0	0.0	0.0	123.1	1.5	e
4	ABL700/800	76	100.0	0.0	0.0	127.0	1.0	e
5	ABL90 FLEX / PLUS	74	100.0	0.0	0.0	126.0	0.5	e
6	ABL80 FLEX CO-OX / O	6	83.3	16.7	0.0	122.0	3.0	e*

Chlorure-BG

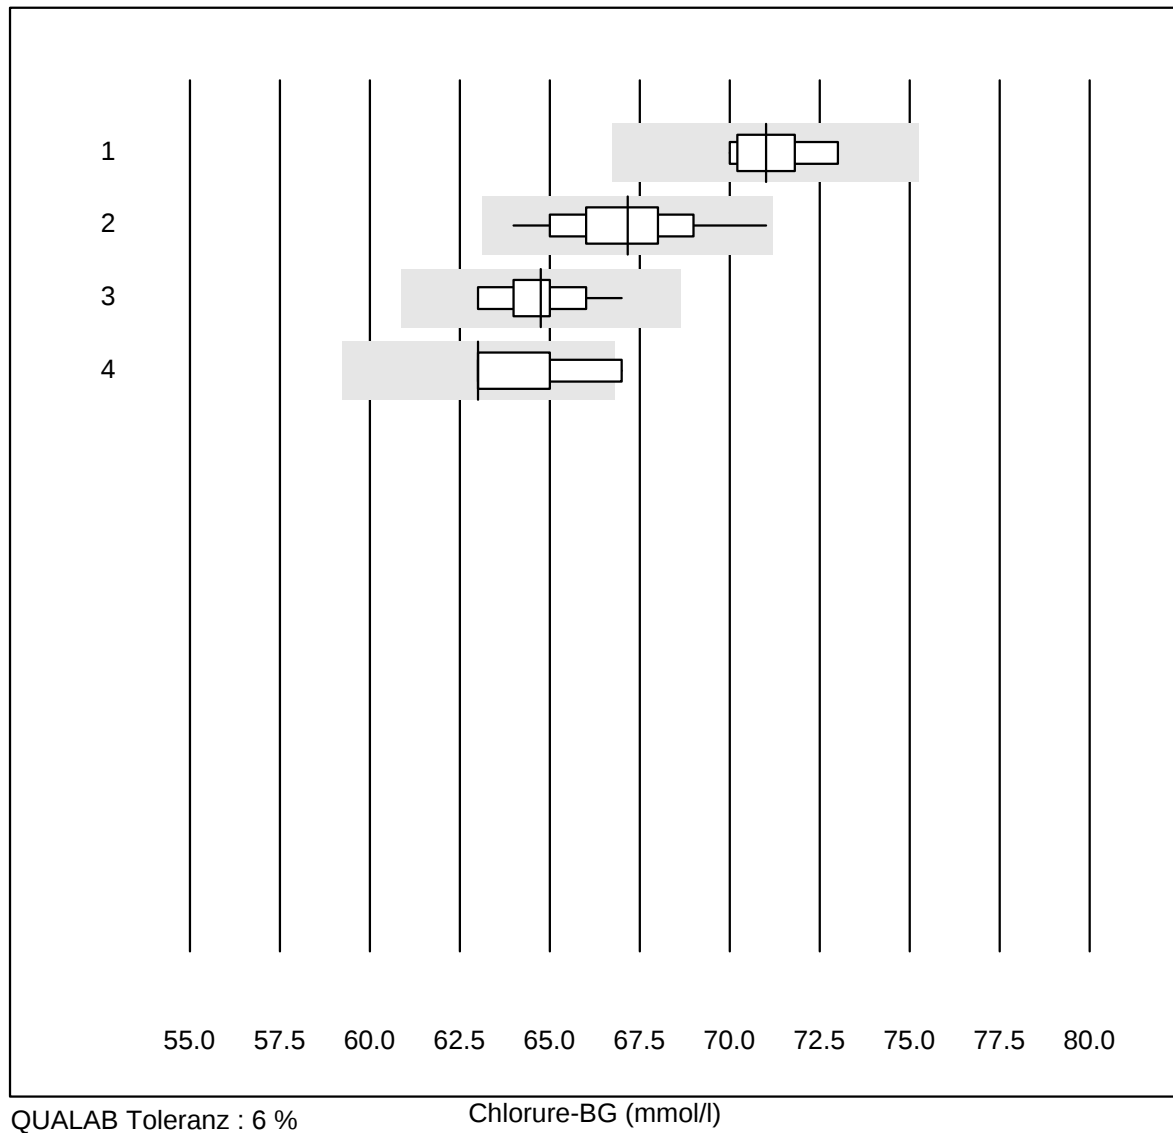


QUALAB Toleranz : 6 %

Chlorure-BG (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas b 123	5	100.0	0.0	0.0	71.0	1.7	e*
2	ABL700/800	72	98.6	0.0	1.4	67.2	2.2	e
3	ABL90 FLEX / PLUS	71	100.0	0.0	0.0	64.7	1.6	e
4	ABL80 FLEX CO-OX / O	4	75.0	25.0	0.0	63.0	3.0	e*

Calcium-BG

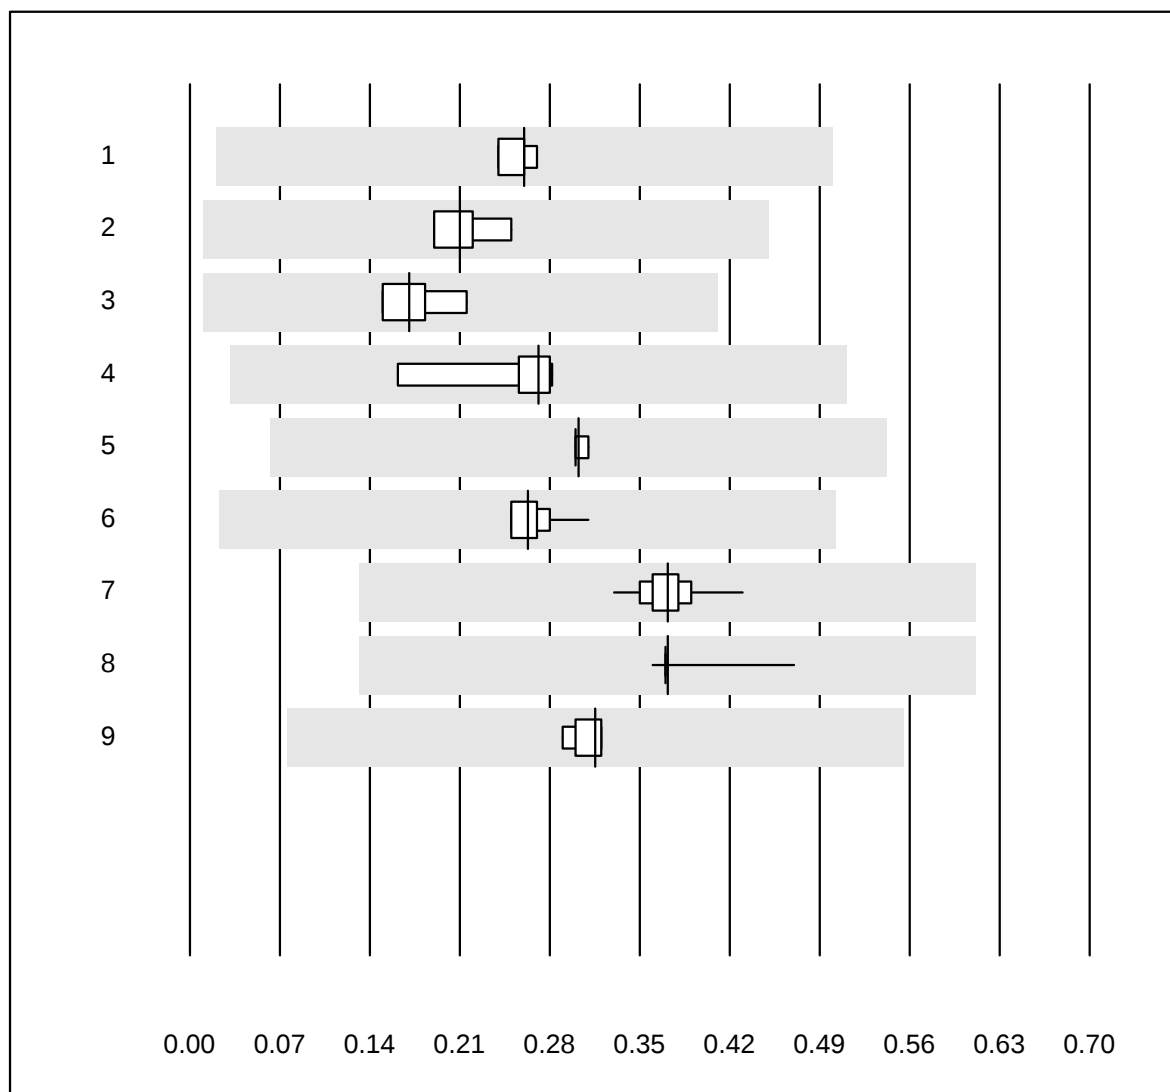


Tolérance MQ : 12 %
(< 2.00: +/- 0.24 mmol/l)

Calcium-BG (mmol/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 GEM	4	100.0	0.0	0.0	0.26	4.9	e*
2 ABL80 FLEX	4	100.0	0.0	0.0	0.21	12.3	e*
3 Cobas b123	4	100.0	0.0	0.0	0.17	16.6	e*
4 Cobas	7	100.0	0.0	0.0	0.27	16.6	e*
5 iStat	11	81.8	0.0	18.2	0.30	1.5	e
6 EPOC	31	96.8	0.0	3.2	0.26	5.8	e
7 ABL700/800	77	100.0	0.0	0.0	0.37	4.3	e
8 ABL90 FLEX / PLUS	74	100.0	0.0	0.0	0.37	3.5	e
9 ABL80 FLEX CO-OX / O	5	100.0	0.0	0.0	0.32	4.2	e*

FHHb

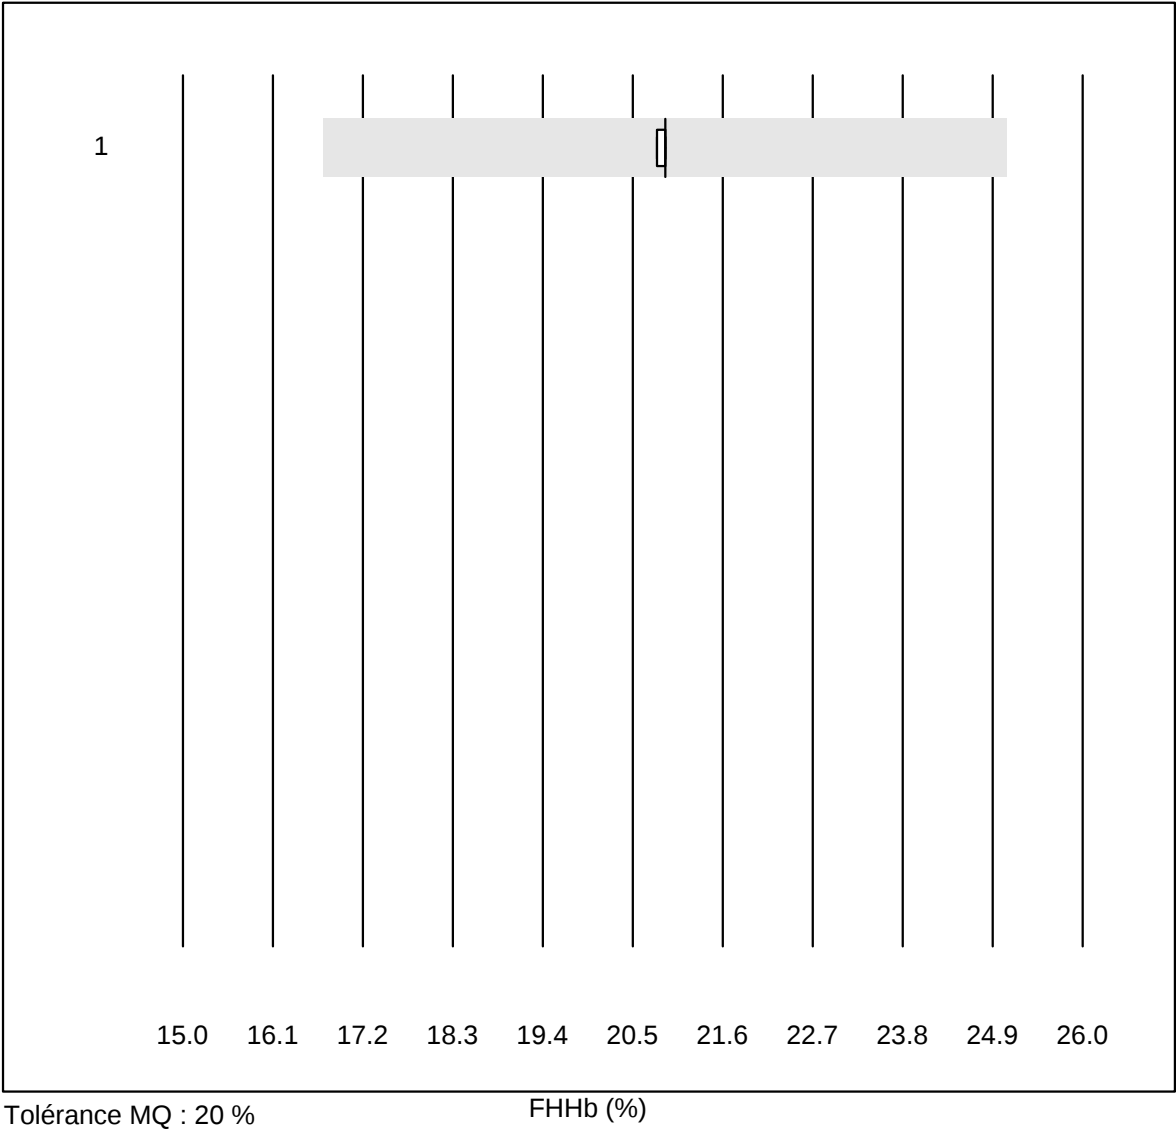

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL80 FLEX CO-OX / O	5	100.0	0.0	0.0	20.900	0.3	e


Lactate-BG

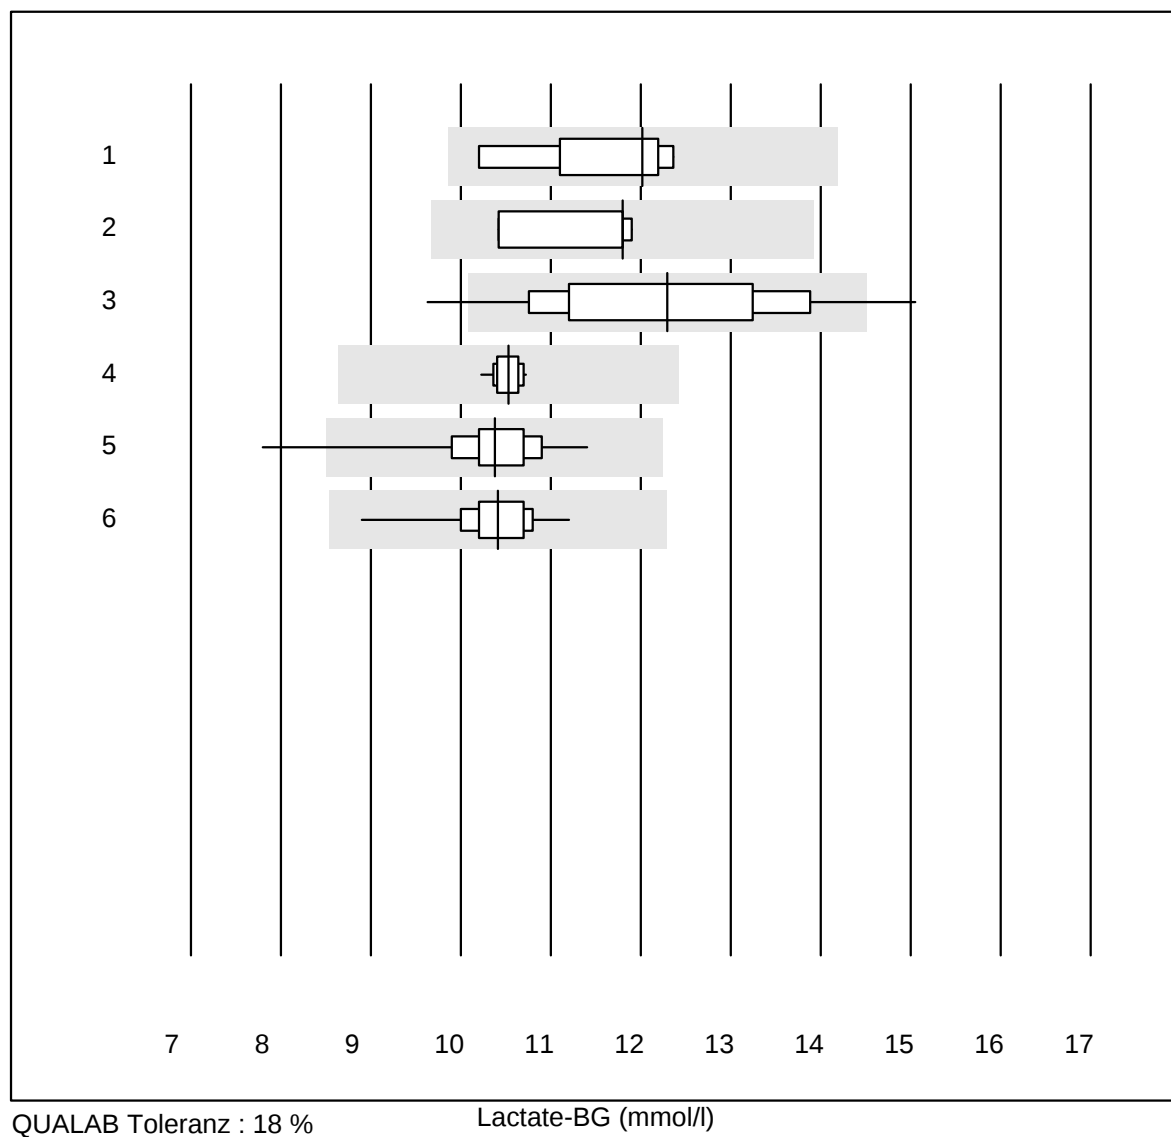

QUALAB Toleranz : 18 %

Lactate-BG (mmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas	6	100.0	0.0	0.0	12.02	7.2	e*
2	IL	4	100.0	0.0	0.0	11.80	6.2	e*
3	EPOC	33	87.9	9.1	3.0	12.30	10.9	e
4	iStat	15	100.0	0.0	0.0	10.53	1.4	e
5	ABL700/800	81	97.5	2.5	0.0	10.37	5.5	e
6	ABL90 FLEX / PLUS	75	100.0	0.0	0.0	10.41	3.8	e

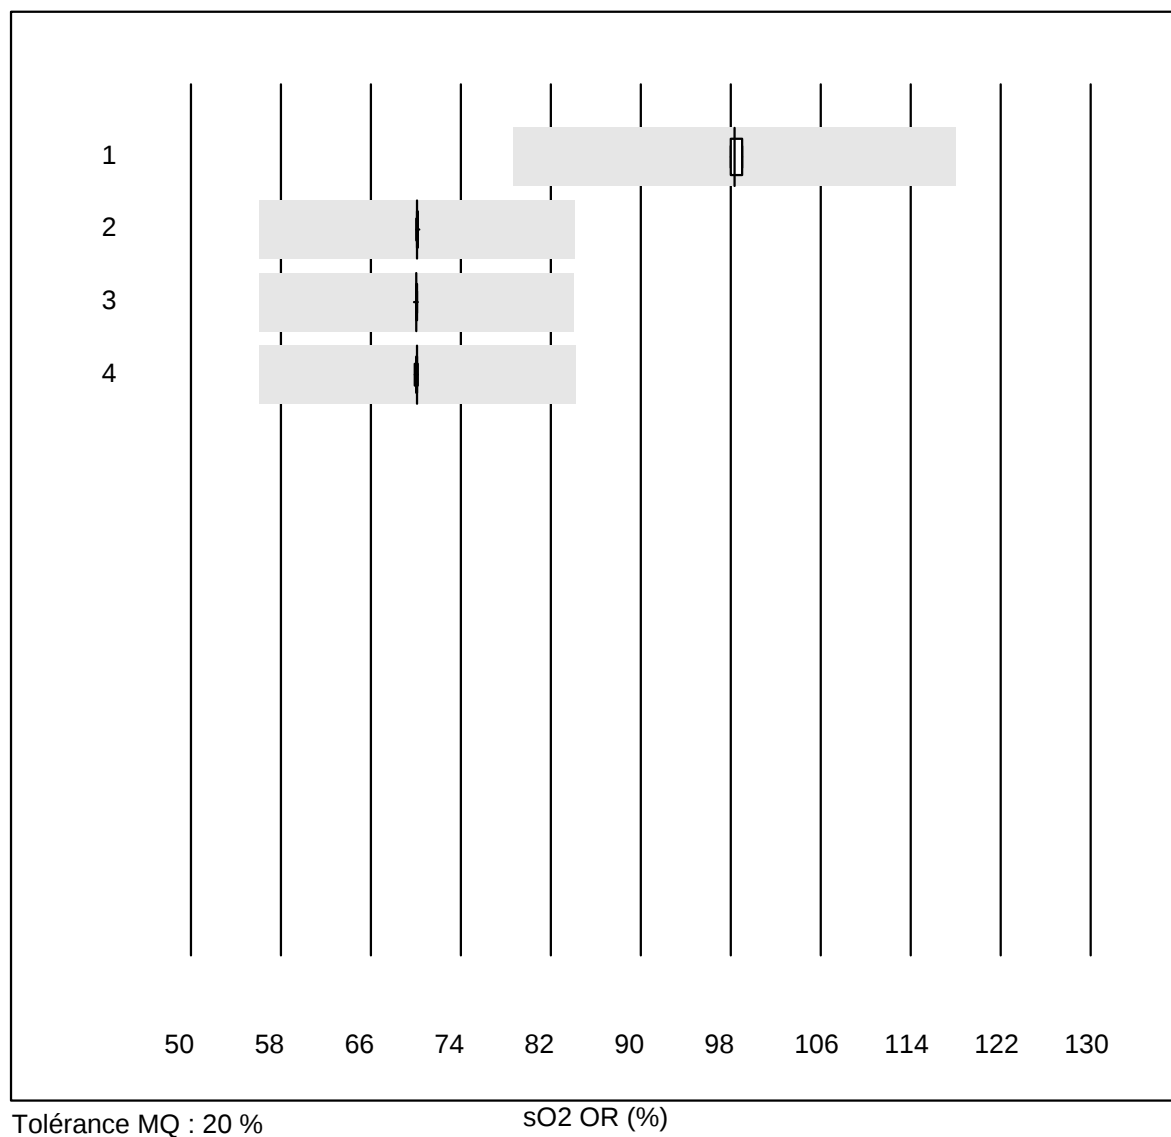sO2 OR

Tolérance MQ : 20 %

sO2 OR (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	iStat	11	100.0	0.0	0.0	98.364	0.5	e
2	ABL700/800	61	100.0	0.0	0.0	70.120	0.1	e
3	ABL90 FLEX / PLUS	63	100.0	0.0	0.0	70.027	0.1	e
4	ABL80 FLEX CO-OX / O	9	100.0	0.0	0.0	70.100	0.1	e

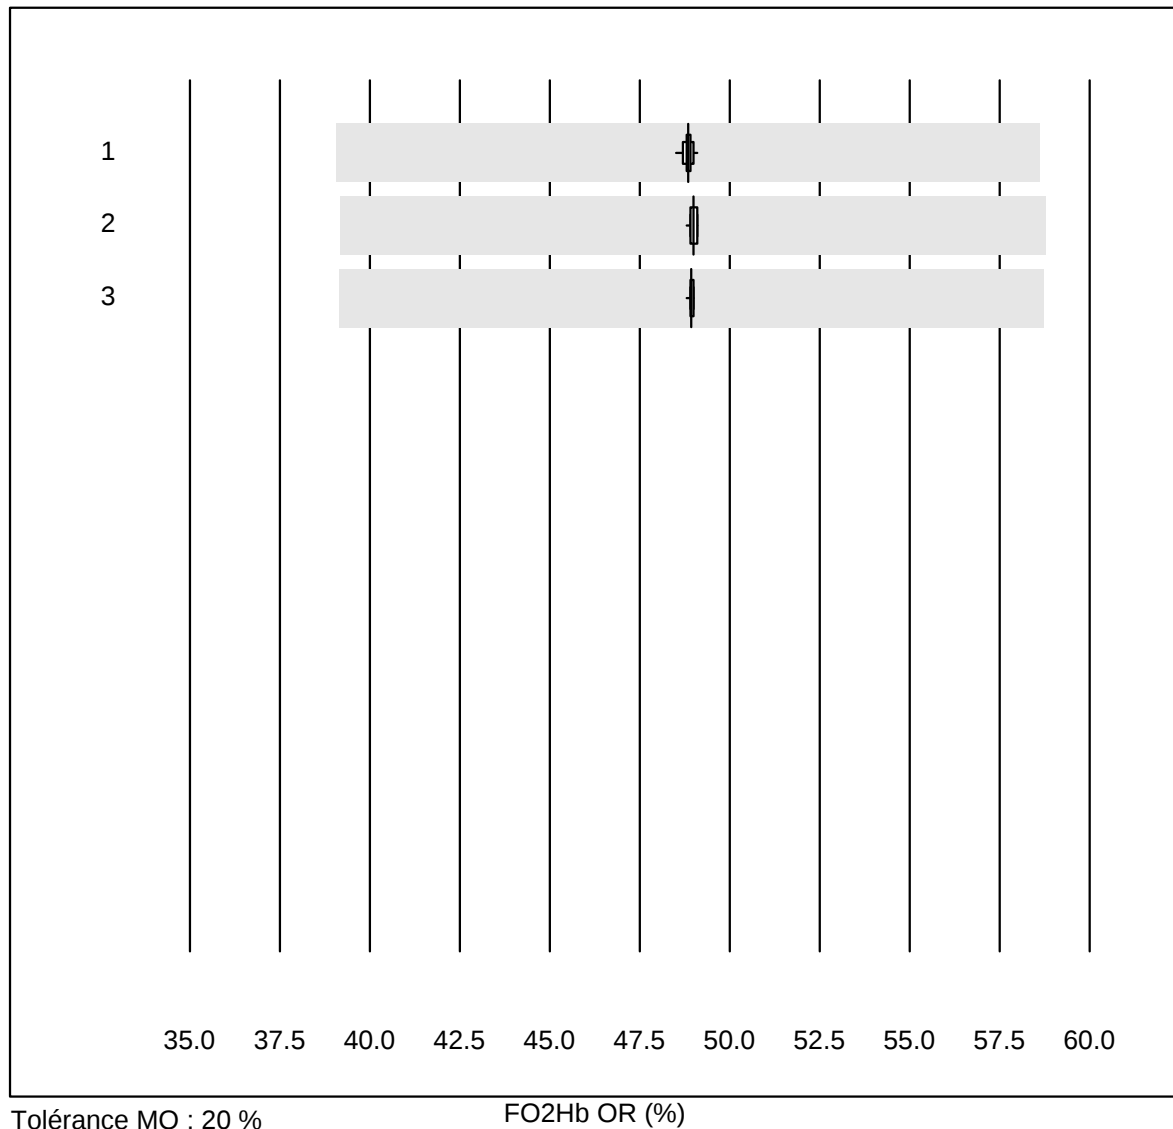
FO2Hb OR

Tolérance MQ : 20 %

FO2Hb OR (%)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL700/800	60	98.3	0.0	1.7	48.839	0.2	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	64	98.4	0.0	1.6	48.987	0.2	e
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	11	100.0	0.0	0.0	48.930	0.1	e

FCOHb OR

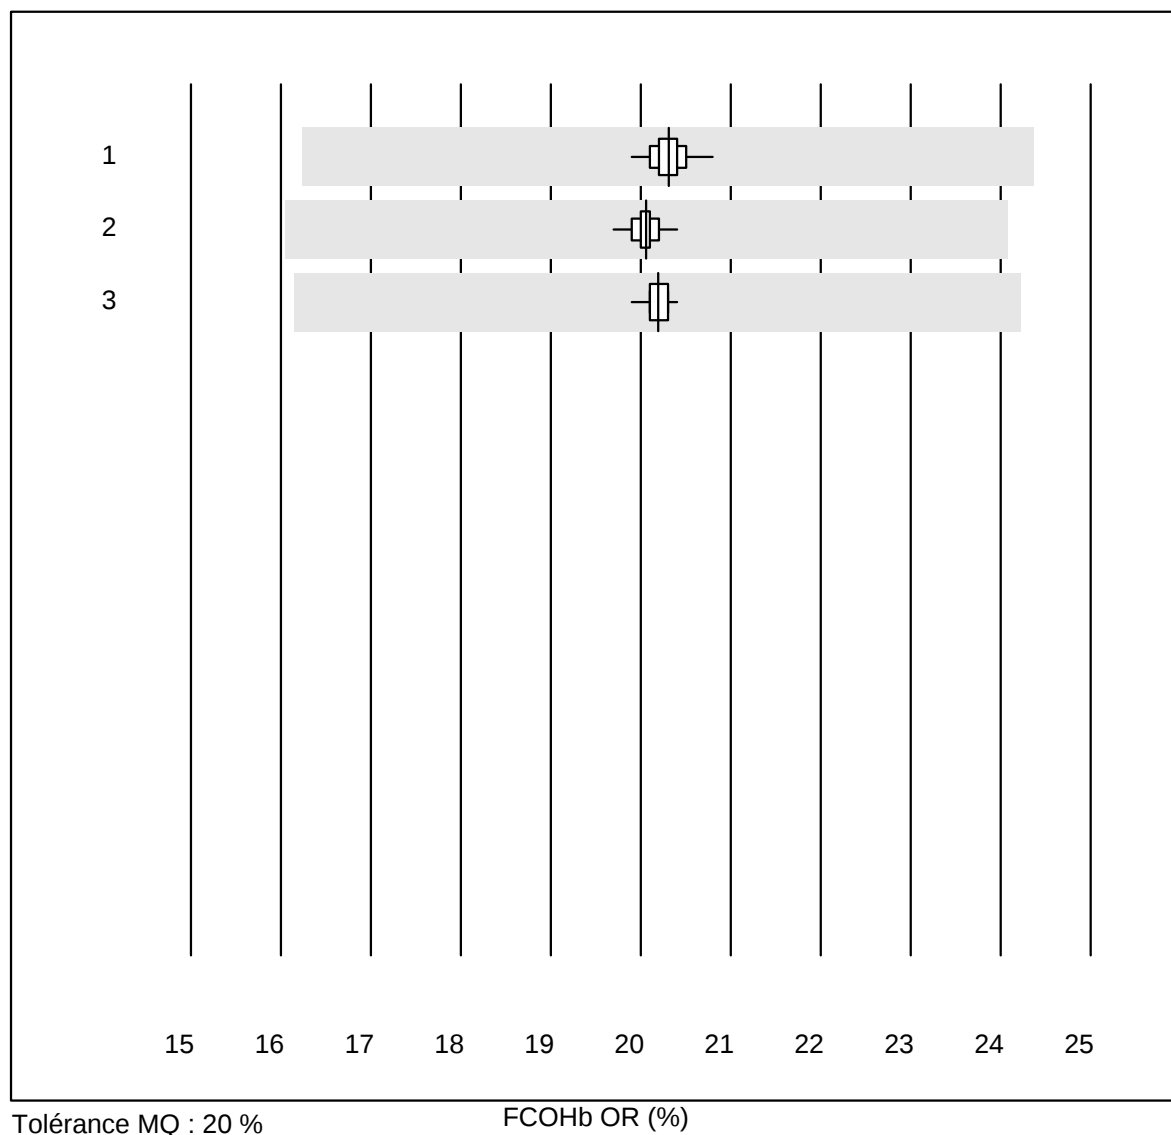

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL700/800	62	100.0	0.0	0.0	20.308	0.9	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	63	100.0	0.0	0.0	20.062	0.6	e
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	11	100.0	0.0	0.0	20.190	0.7	e

FMetHb OR

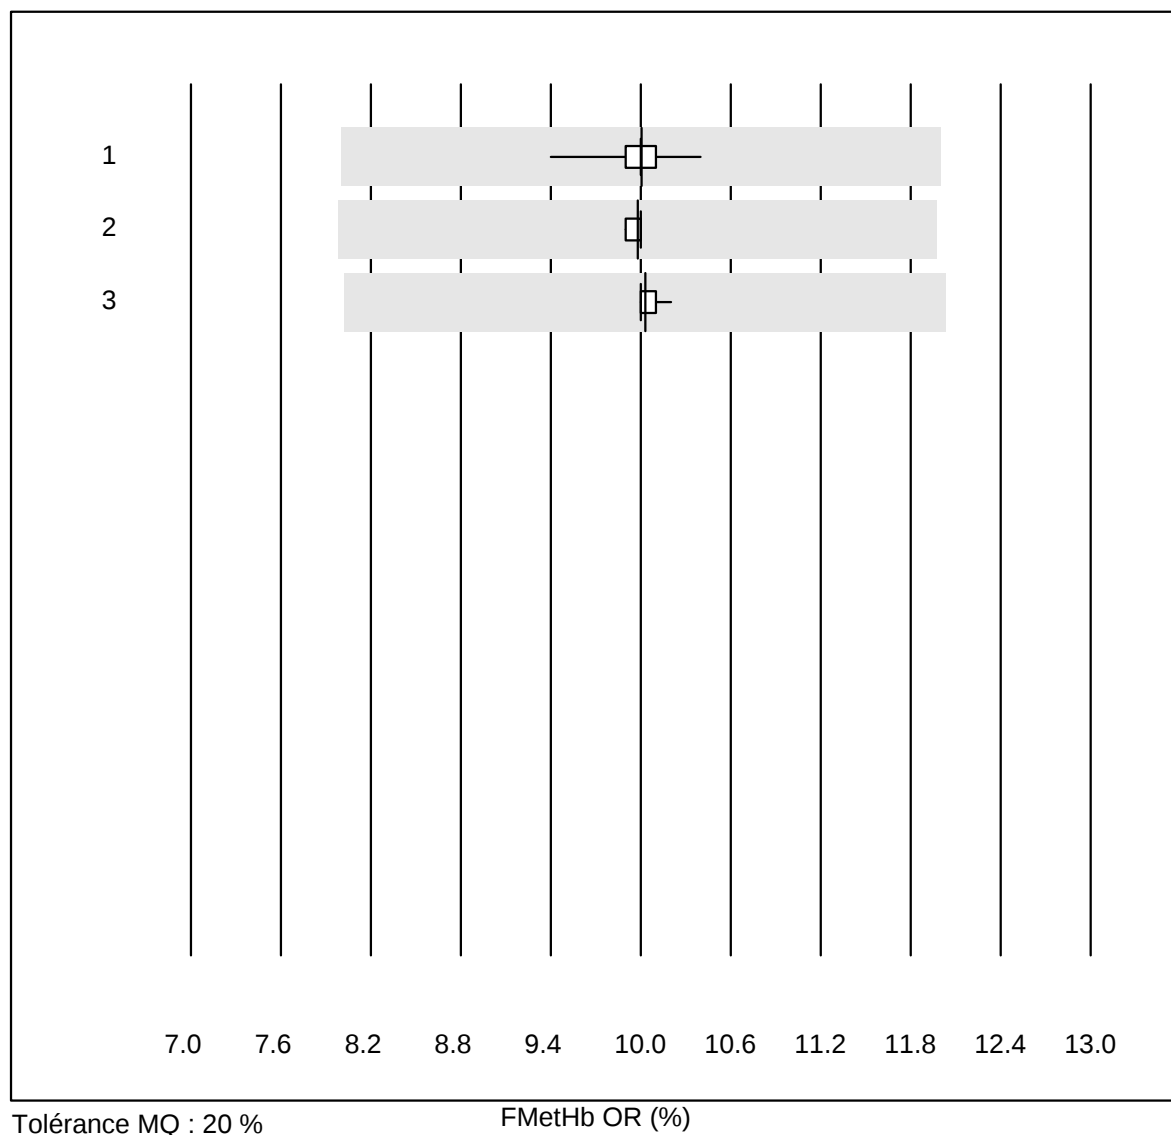


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL700/800	64	100.0	0.0	0.0	10.003	1.3	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	63	98.4	0.0	1.6	9.979	0.4	e
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	11	90.9	0.0	9.1	10.030	0.7	e

FHbF OR



Nr. Methode		Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL90 FLEX / PLUS	15	100.0	0.0	0.0	50.600	3.9	e

Bilirubin OR

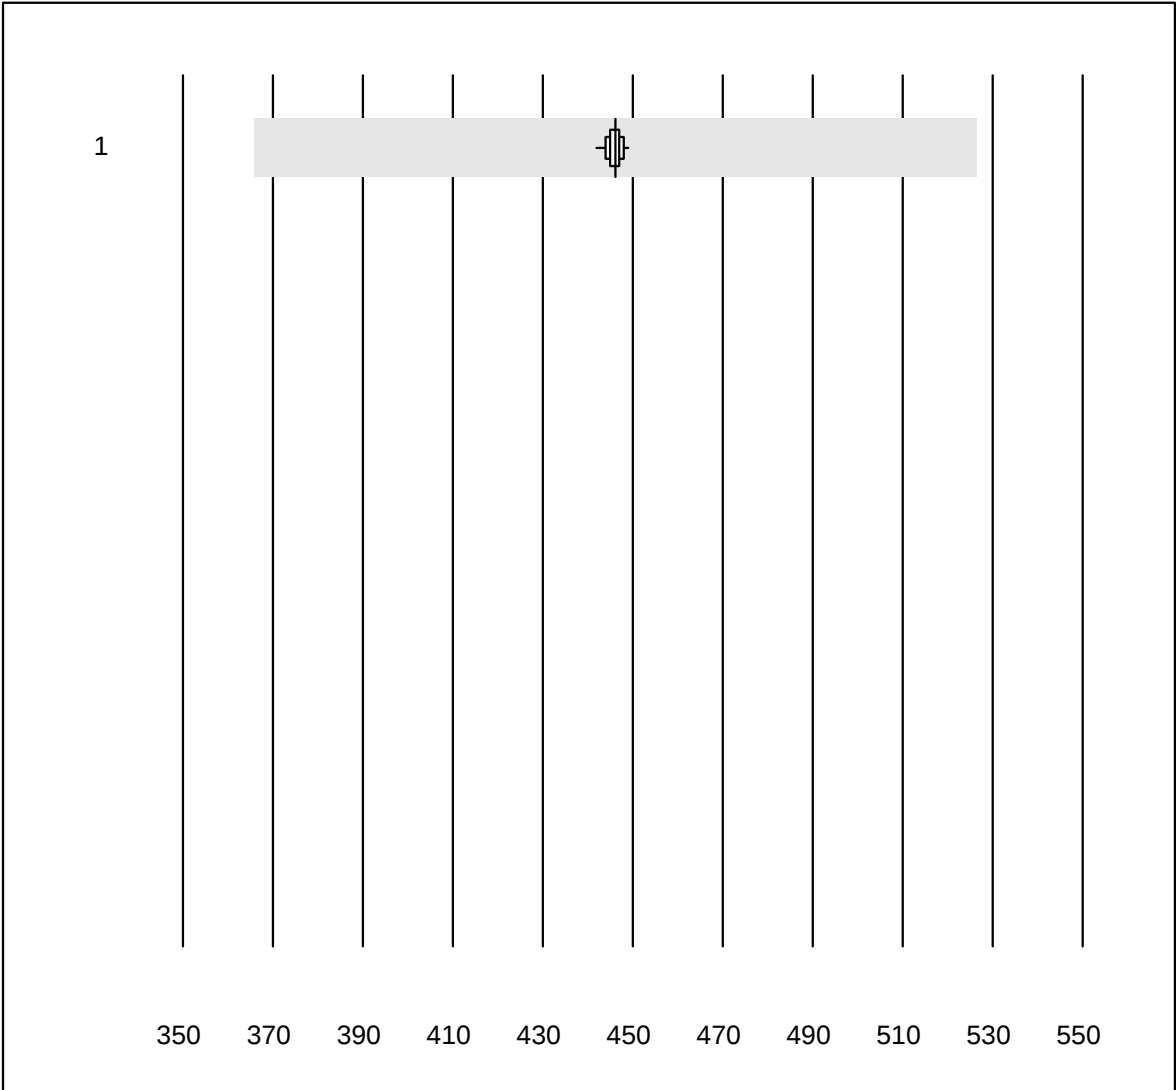


QUALAB Toleranz : 18 %

Bilirubin OR (μmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL90 FLEX / PLUS	24	100.0	0.0	0.0	446.1	0.4	e

Troponine I

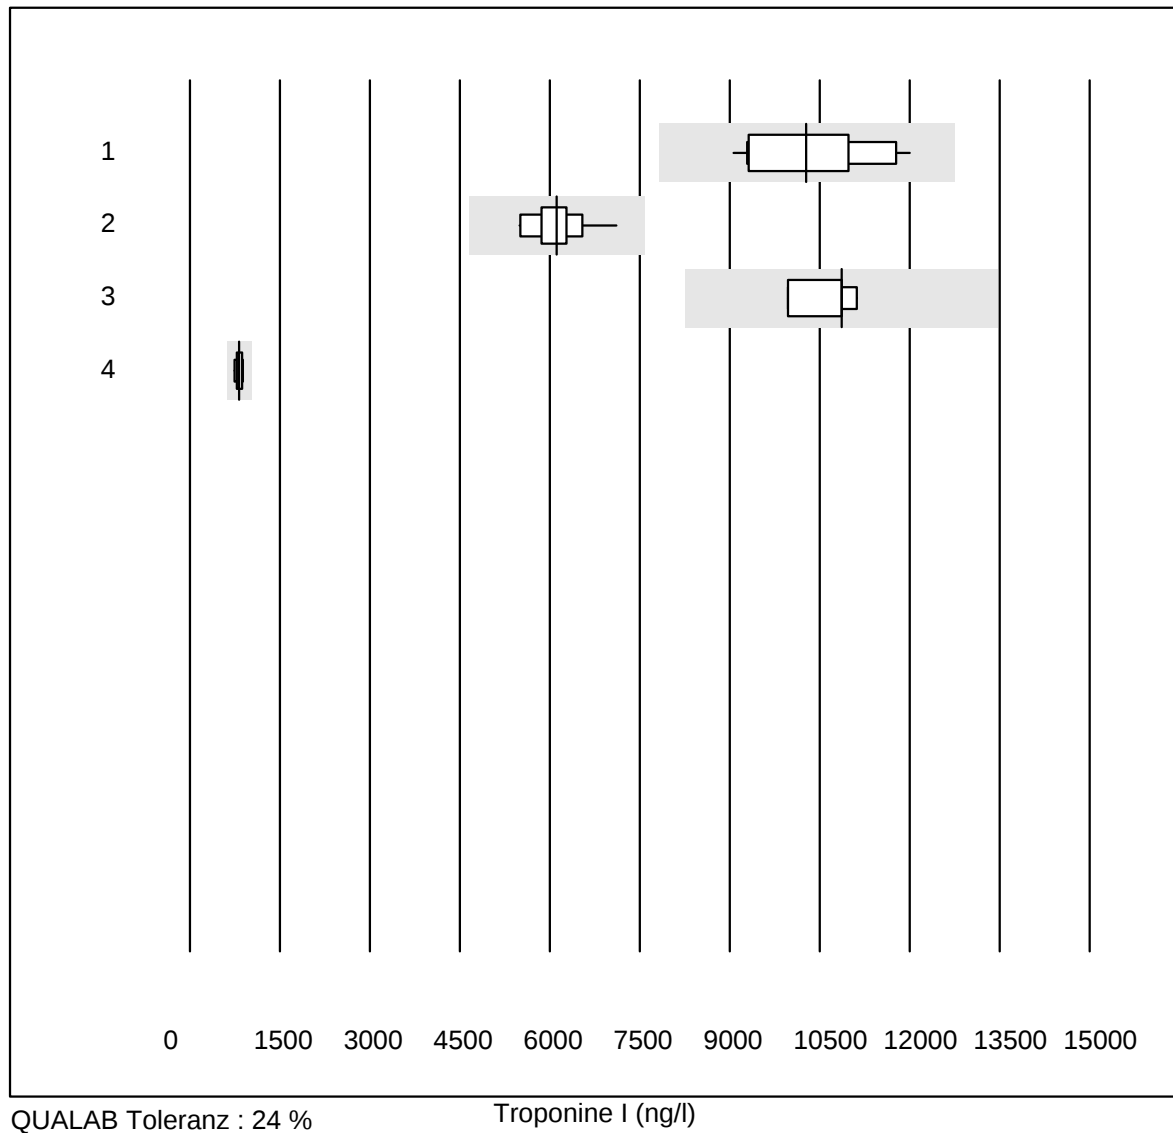


QUALAB Toleranz : 24 %

Troponine I (ng/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Vidas	13	100.0	0.0	0.0	10277.1	9.4	e
2	Architect High Sensi	12	100.0	0.0	0.0	6112.5	7.4	e
3	Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	10861.0	4.6	e
4	AQT 90 FLEX	7	100.0	0.0	0.0	820.0	6.0	e

Troponine T

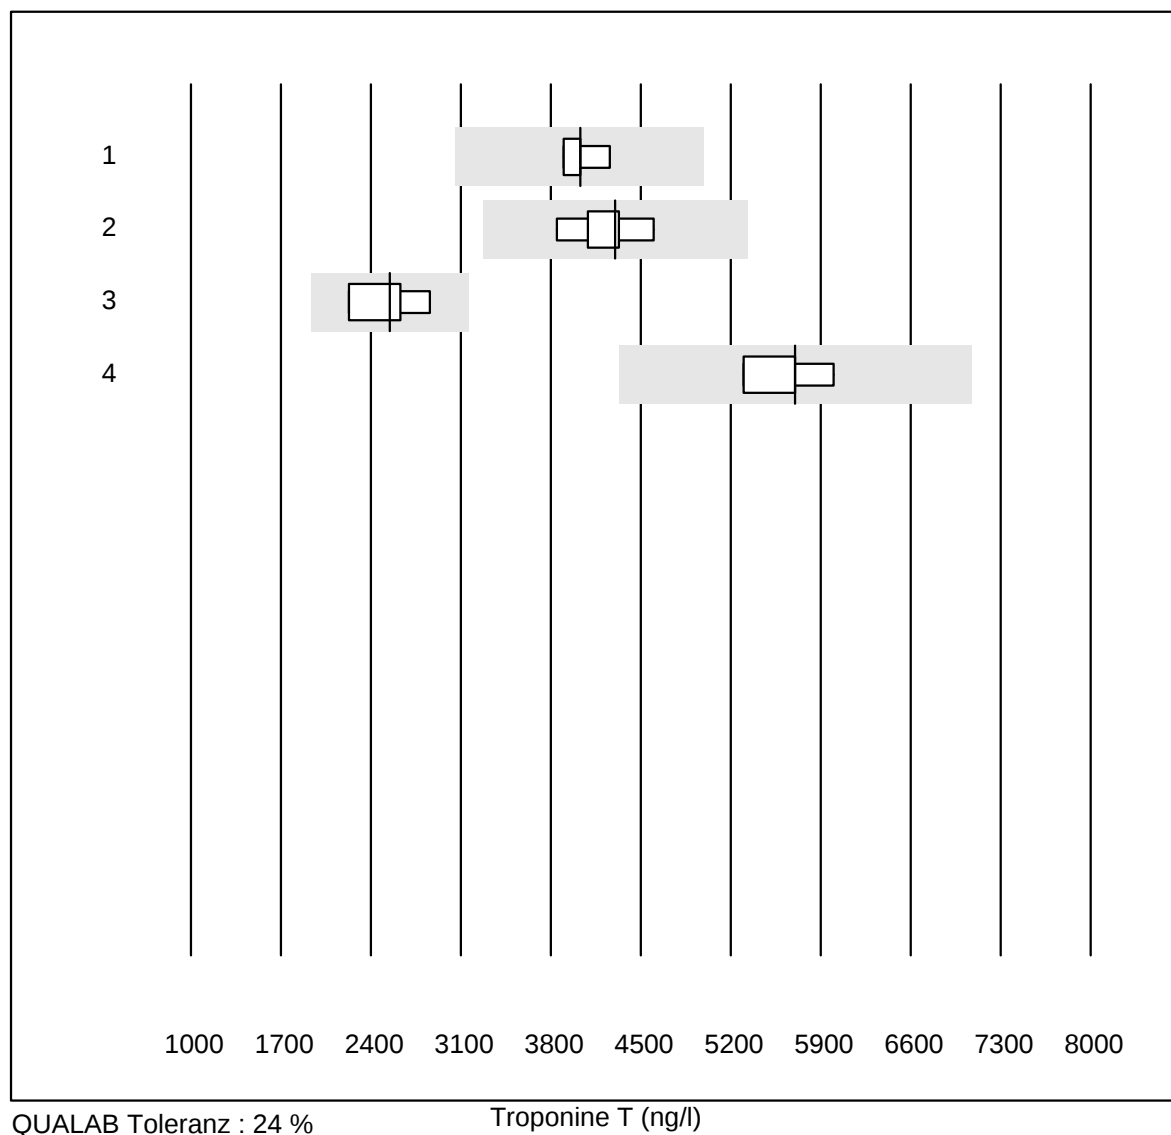

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas hs	4	100.0	0.0	0.0	4027.50	3.7	e
2	Cobas hs STAT	9	100.0	0.0	0.0	4300.00	5.6	e
3	Cobas E / Elecsys	4	100.0	0.0	0.0	2548.00	10.4	e*
4	AQT 90 FLEX	4	100.0	0.0	0.0	5700.00	5.1	e

Myoglobine

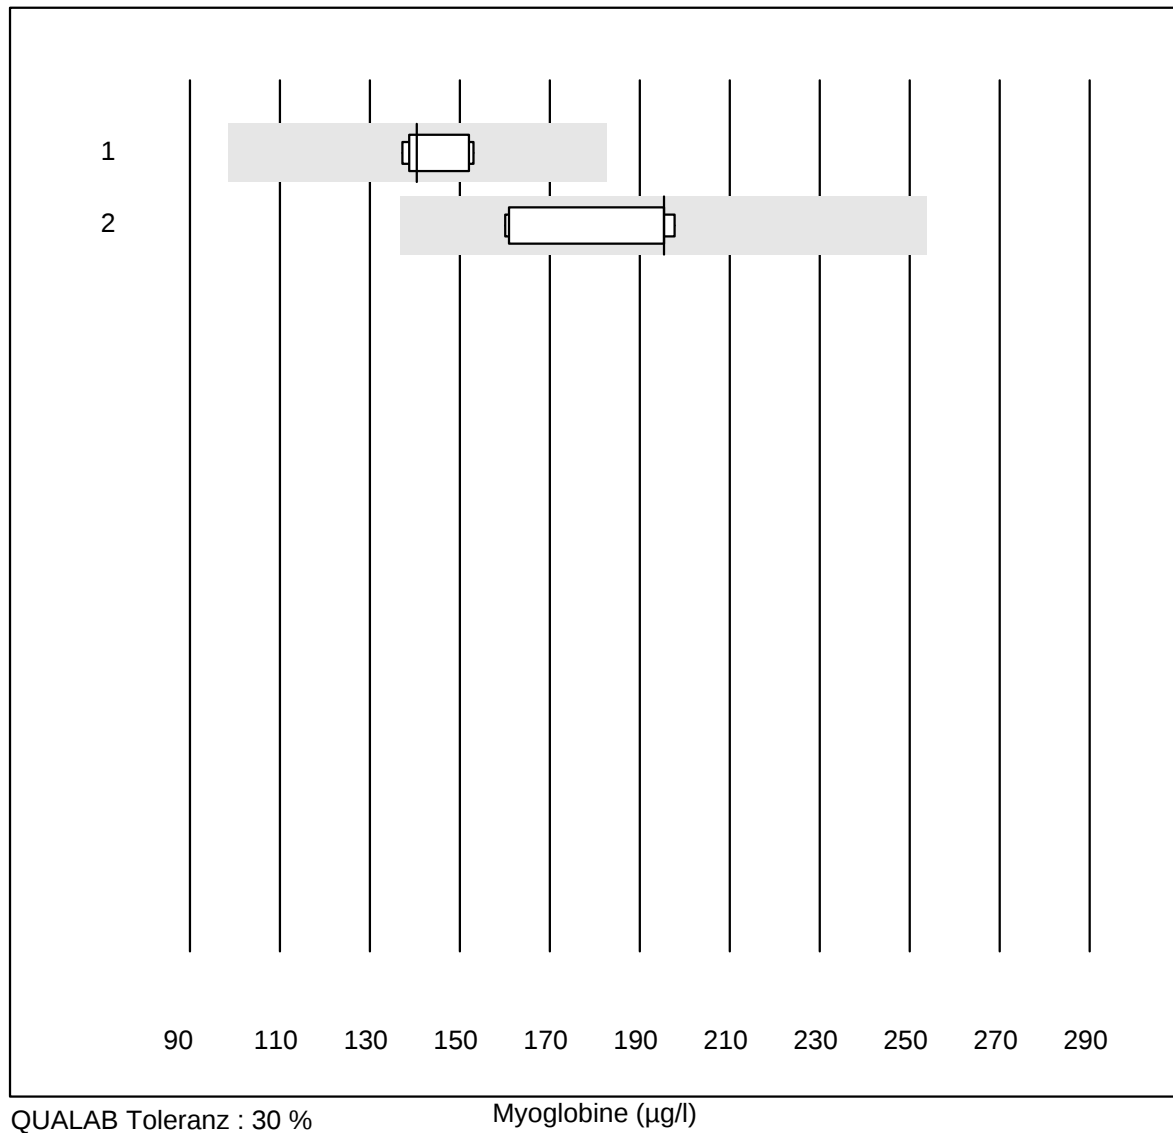


QUALAB Toleranz : 30 %

Myoglobine (µg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	6	100.0	0.0	0.0	140.5	4.8	e
2	Architect	5	100.0	0.0	0.0	195.3	10.7	e*

masse CK-MB

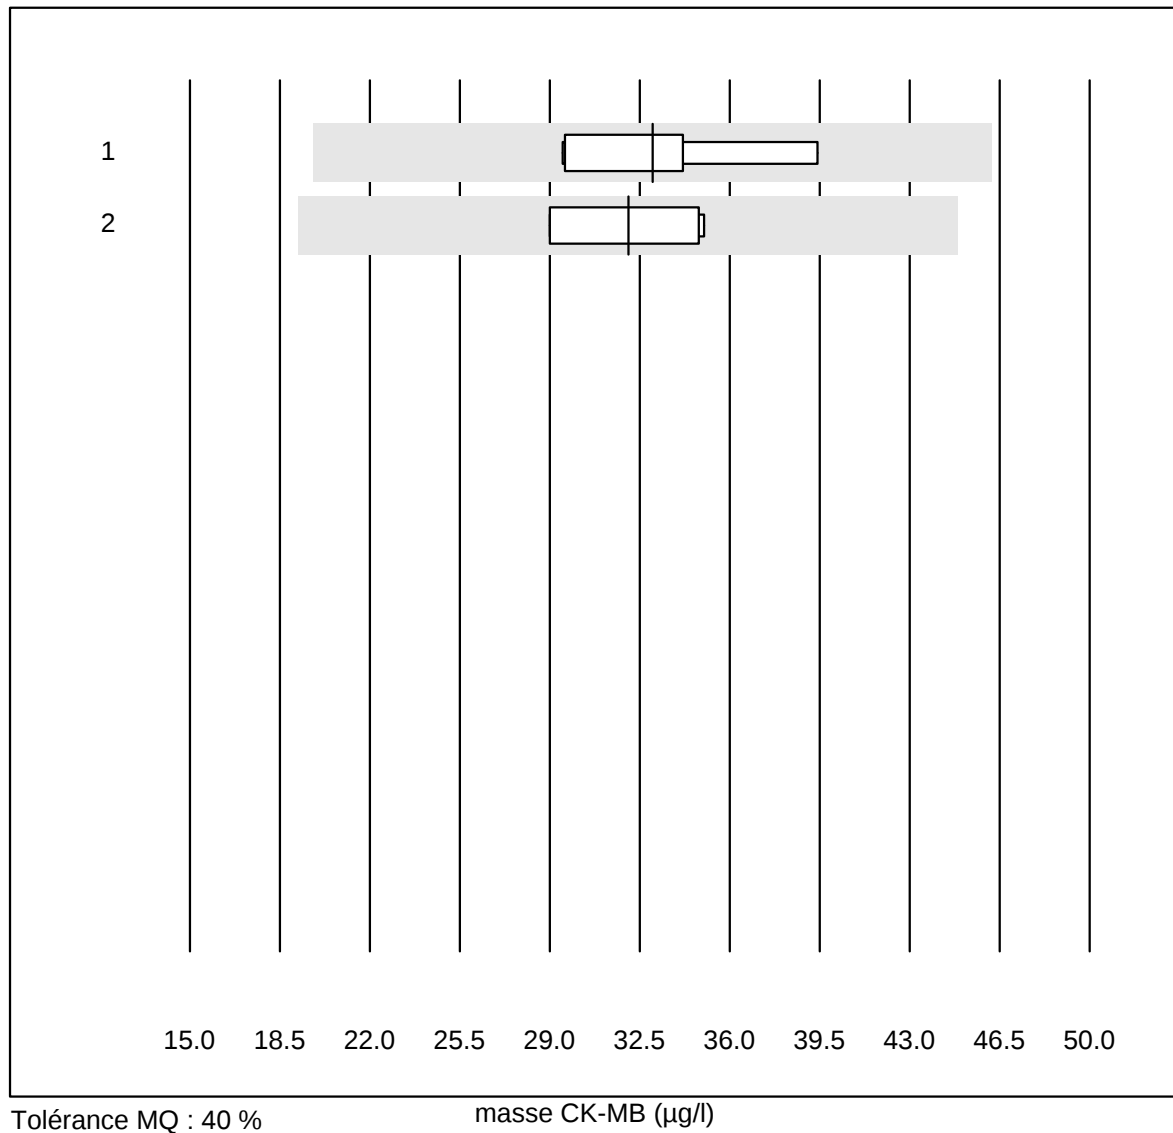


Tolérance MQ : 40 %

masse CK-MB (µg/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Architect	5	100.0	0.0	0.0	33.0	12.3	e*
2	Cobas E / Elecsys	4	100.0	0.0	0.0	32.1	10.4	e*


NT-proBNP

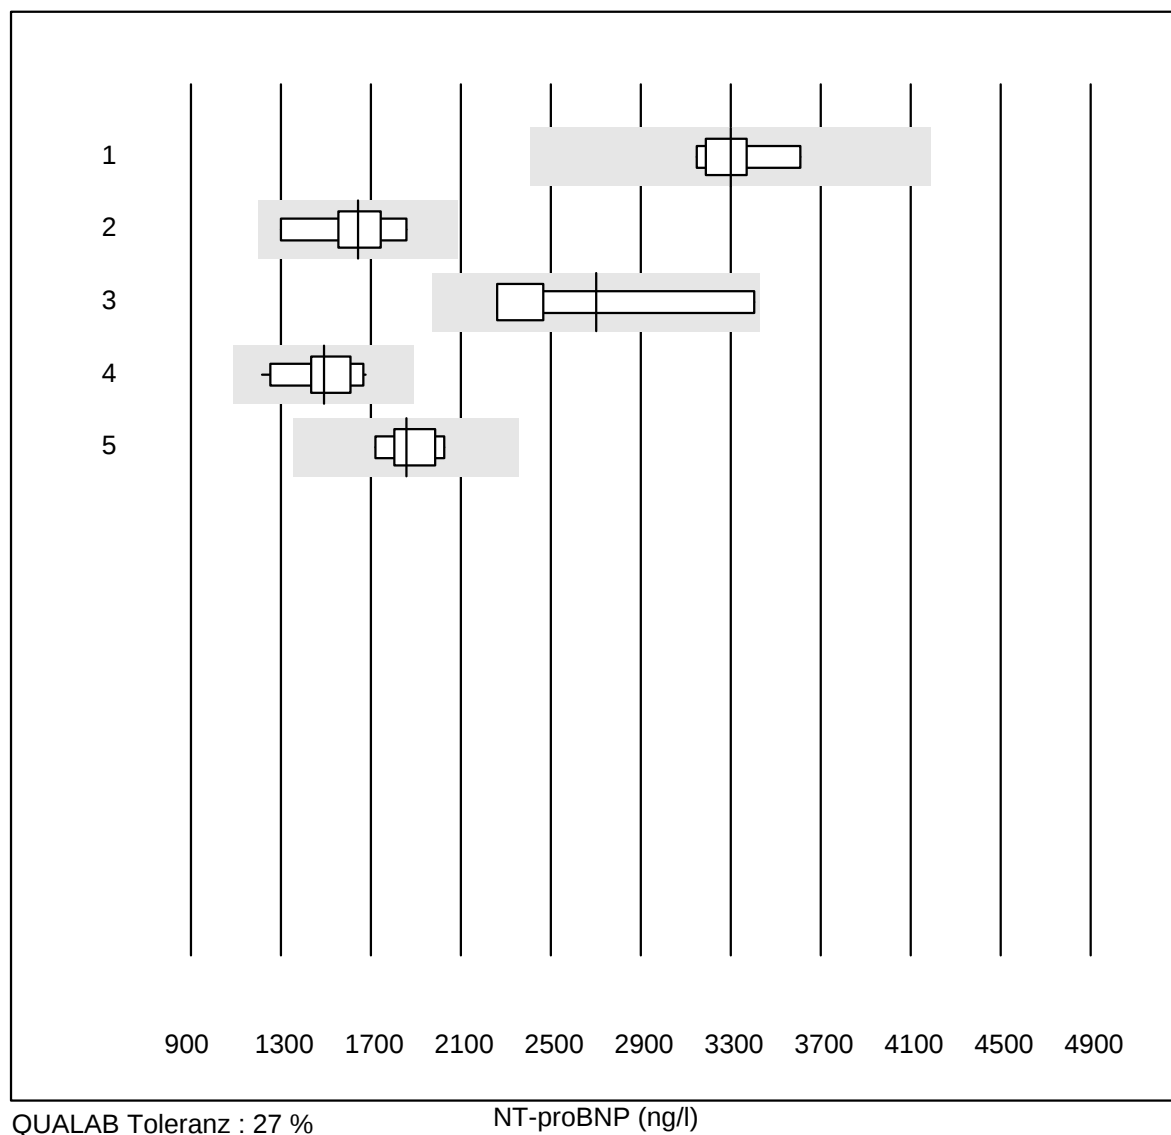


Nr.	Méthode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	AQT 90 FLEX	8	100.0	0.0	0.0	3300.0	4.5	e
2	VIDAS	9	100.0	0.0	0.0	1642.0	11.5	e*
3	Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	2700.0	20.3	a
4	Cobas E / Elecsys	16	100.0	0.0	0.0	1490.0	9.1	e
5	Architect	5	100.0	0.0	0.0	1858.0	6.7	e

TSH

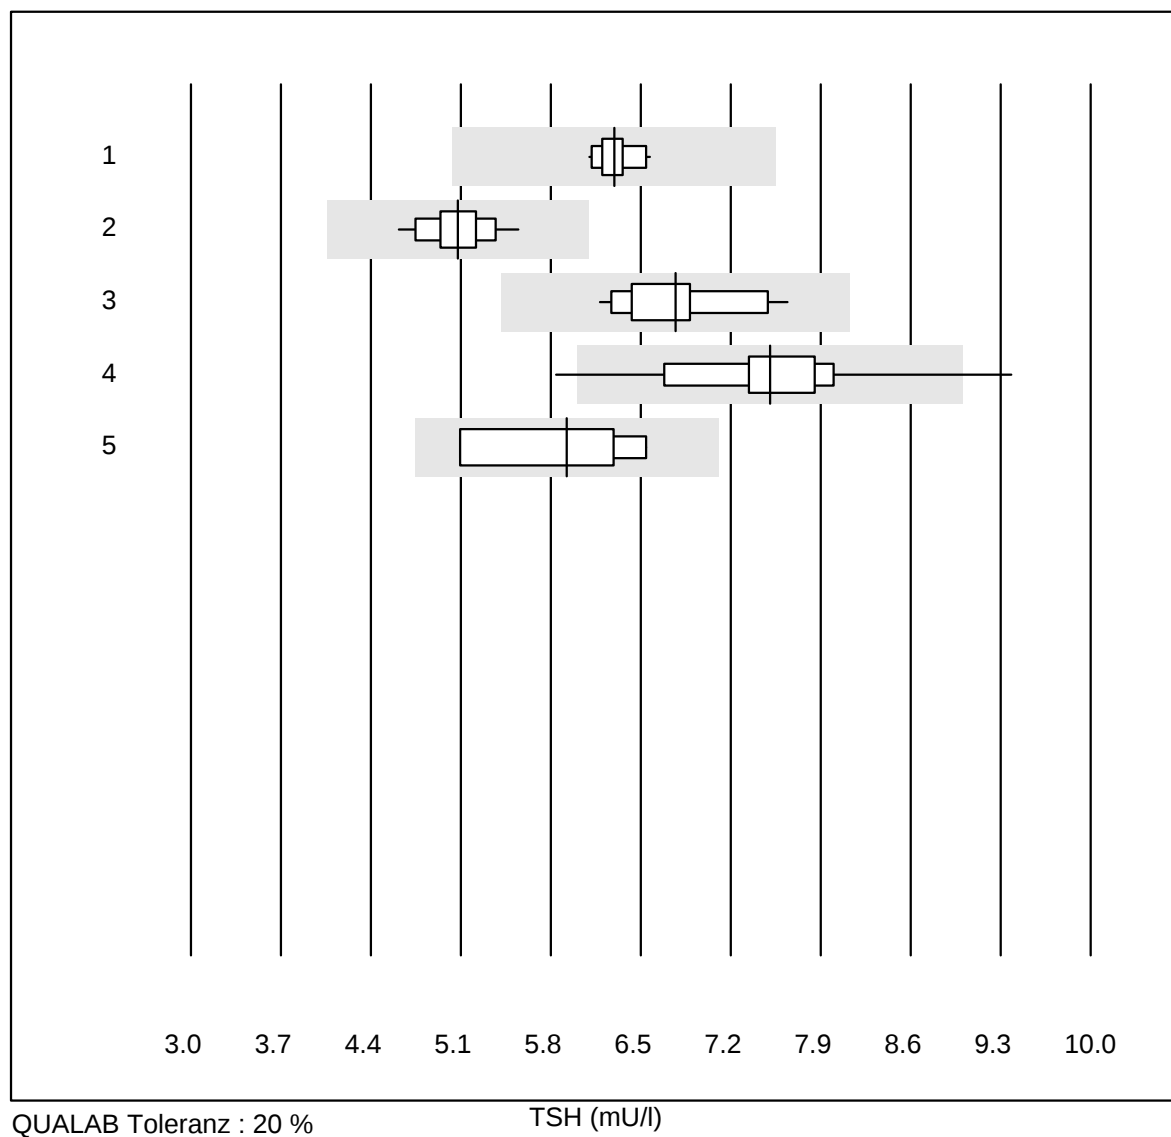


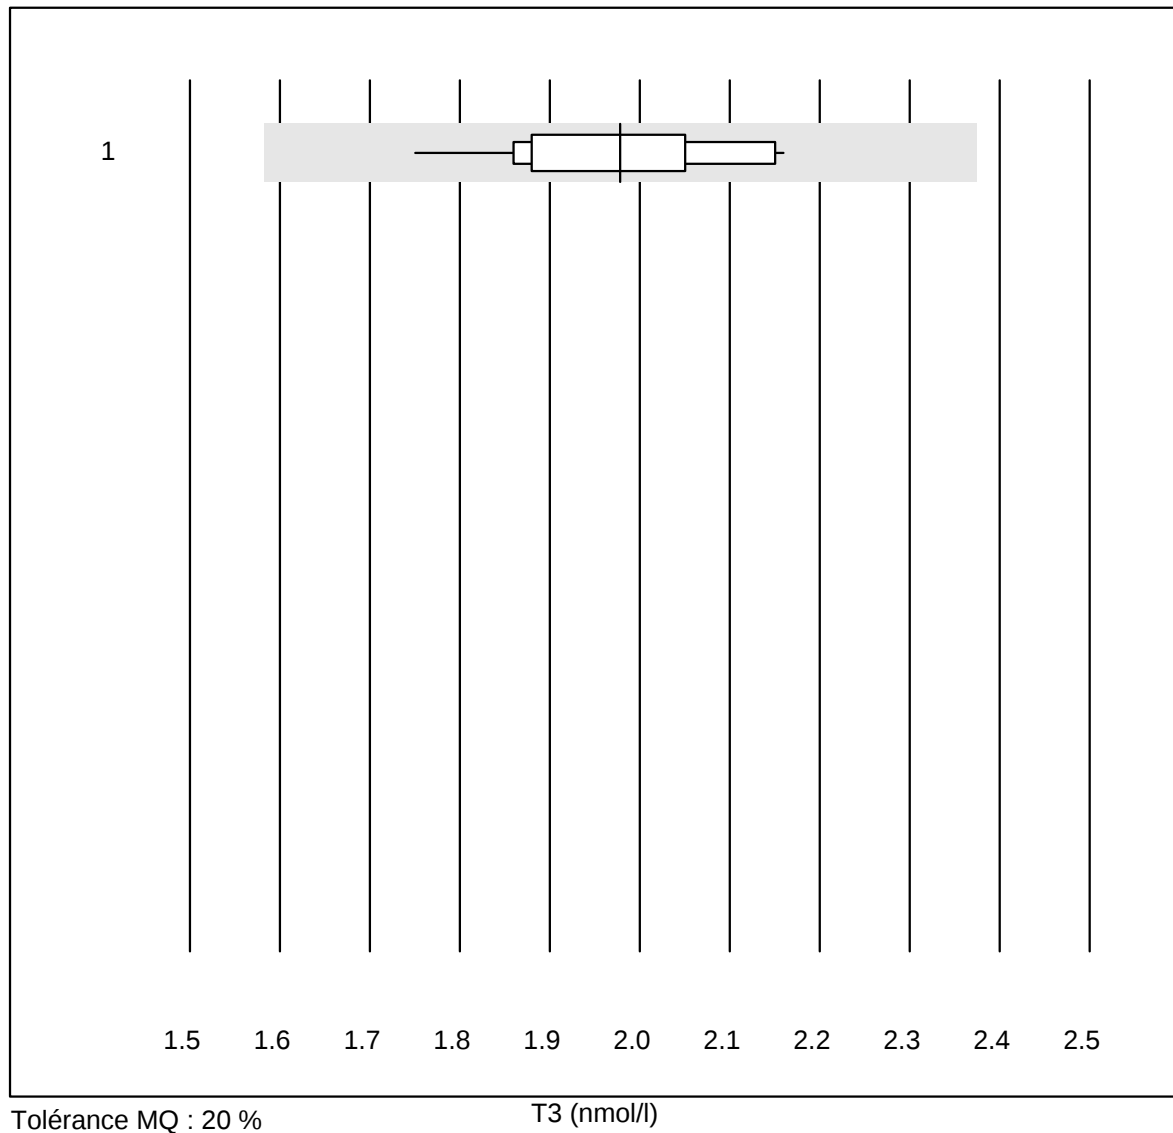T3

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	AFIAS	11	100.0	0.0	0.0	2.0	6.2	e

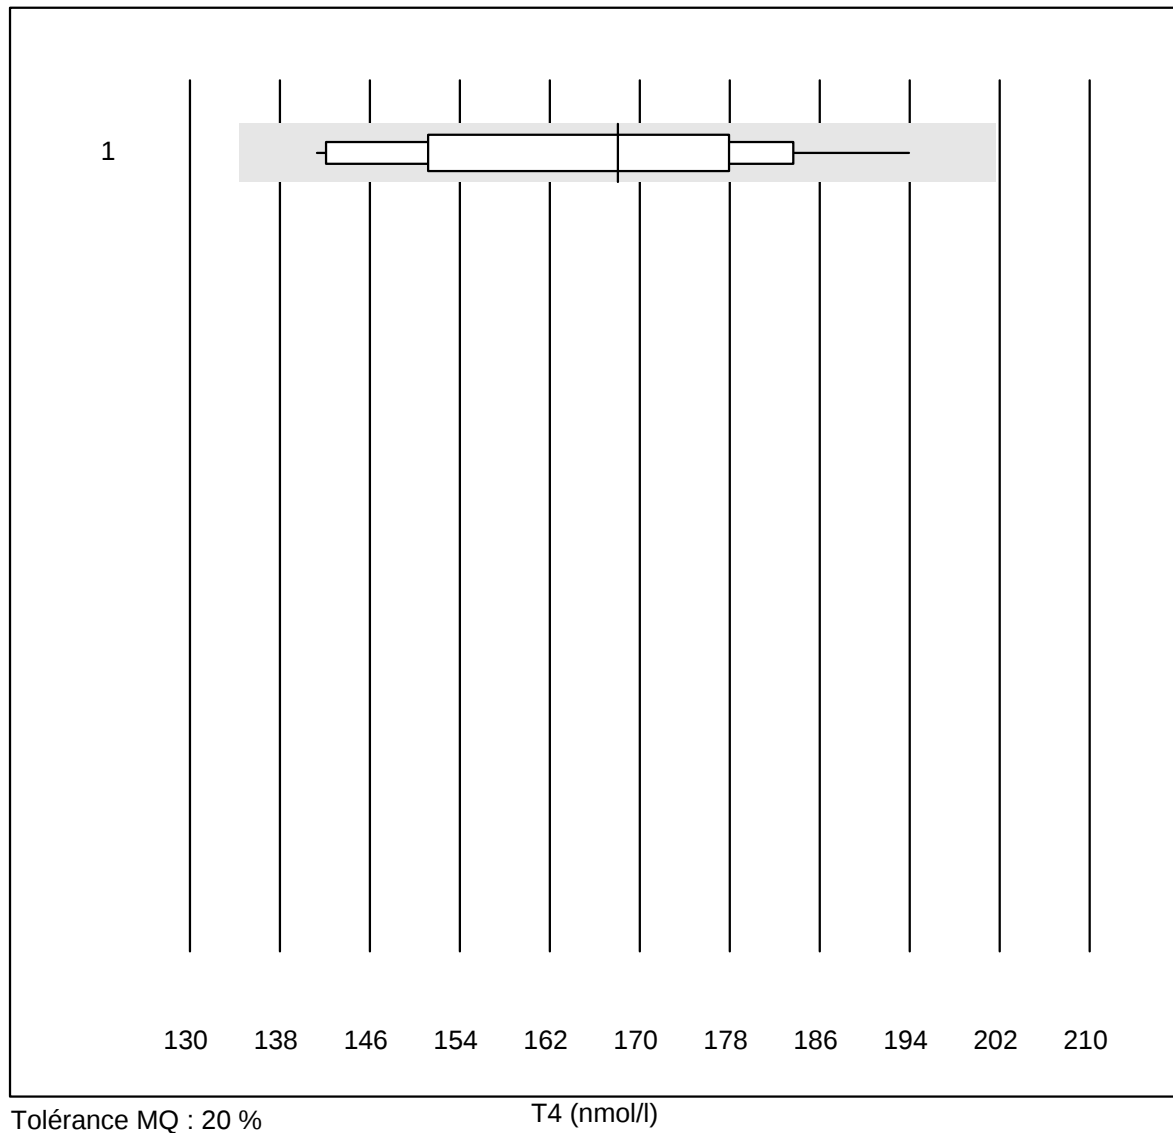T4


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	AFIAS	12	100.0	0.0	0.0	168	9.9	e*

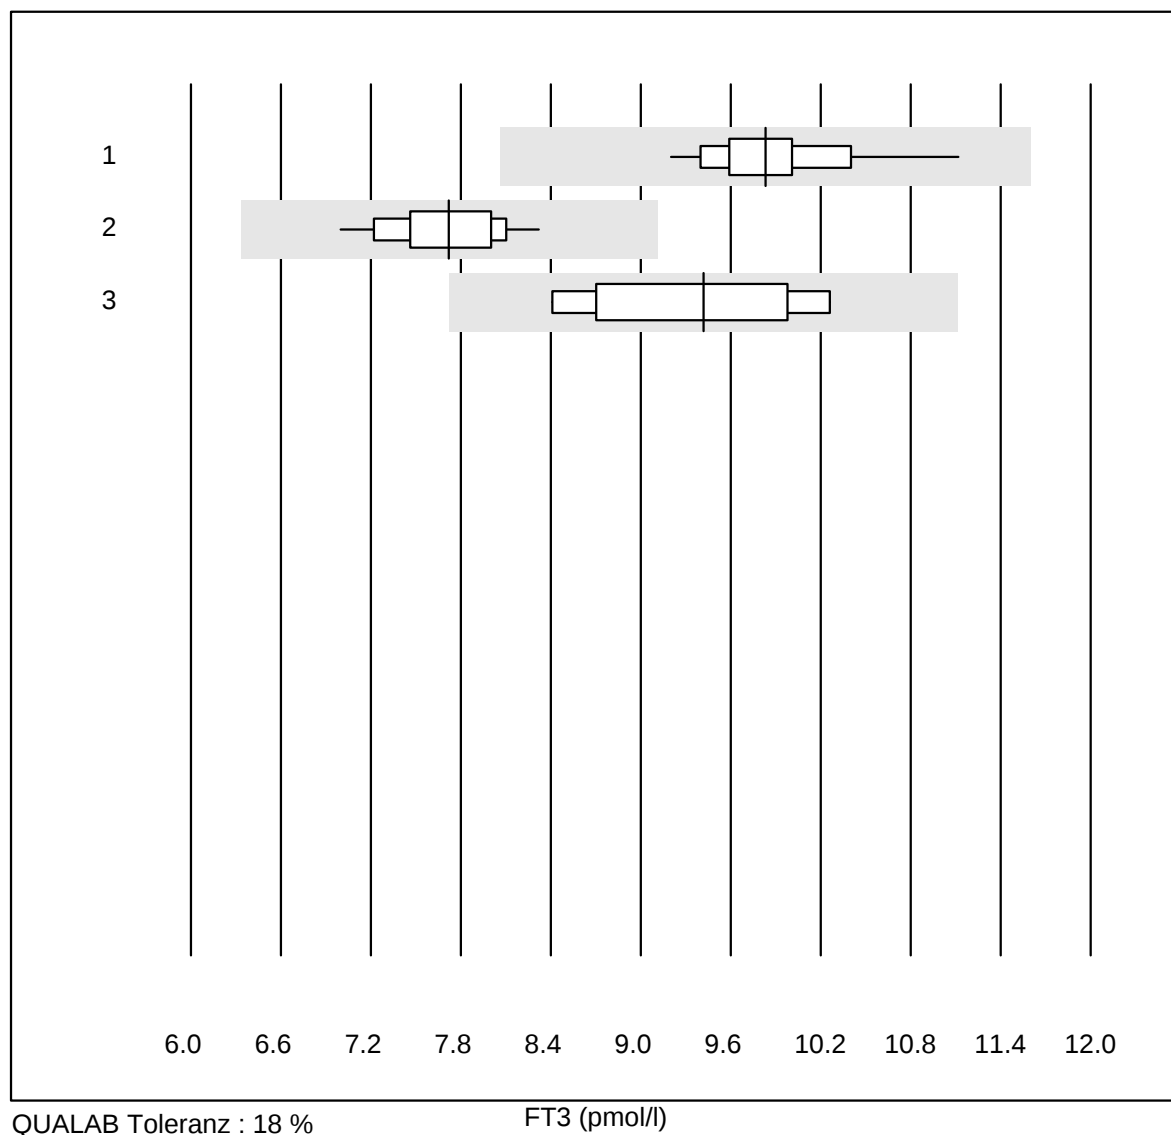FT3

QUALAB Toleranz : 18 %


FT3 (pmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	15	100.0	0.0	0.0	9.8	4.7	e
2	Architect	12	100.0	0.0	0.0	7.7	4.9	e
3	VIDAS	8	100.0	0.0	0.0	9.4	8.0	e*

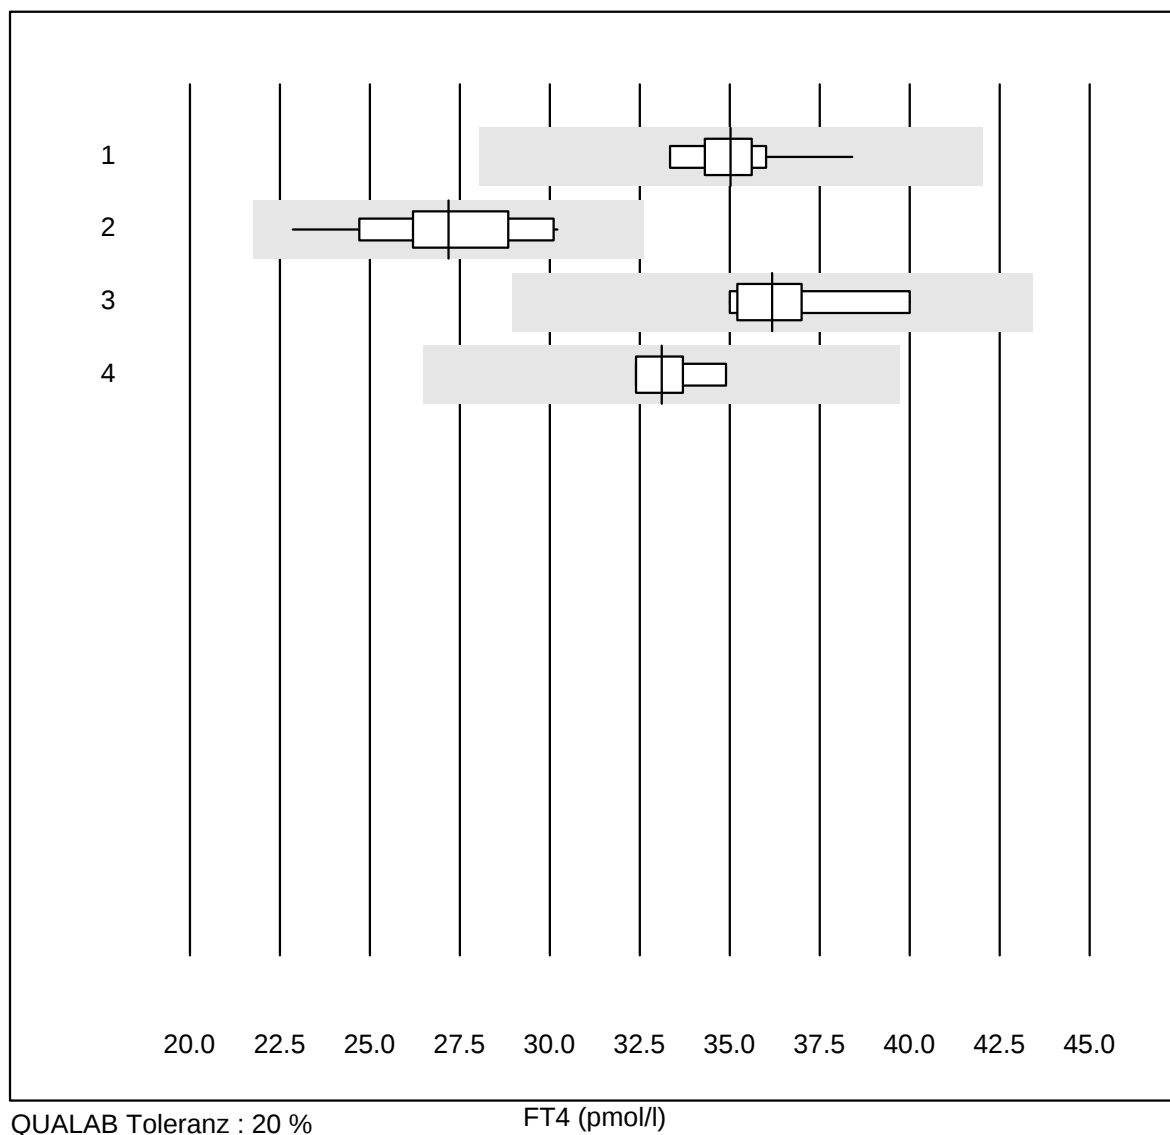FT4

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	16	100.0	0.0	0.0	35.0	3.6	e
2	Architect	14	92.9	0.0	7.1	27.2	7.7	e
3	VIDAS	8	100.0	0.0	0.0	36.2	5.1	e
4	Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	33.1	3.5	e

Testostérone

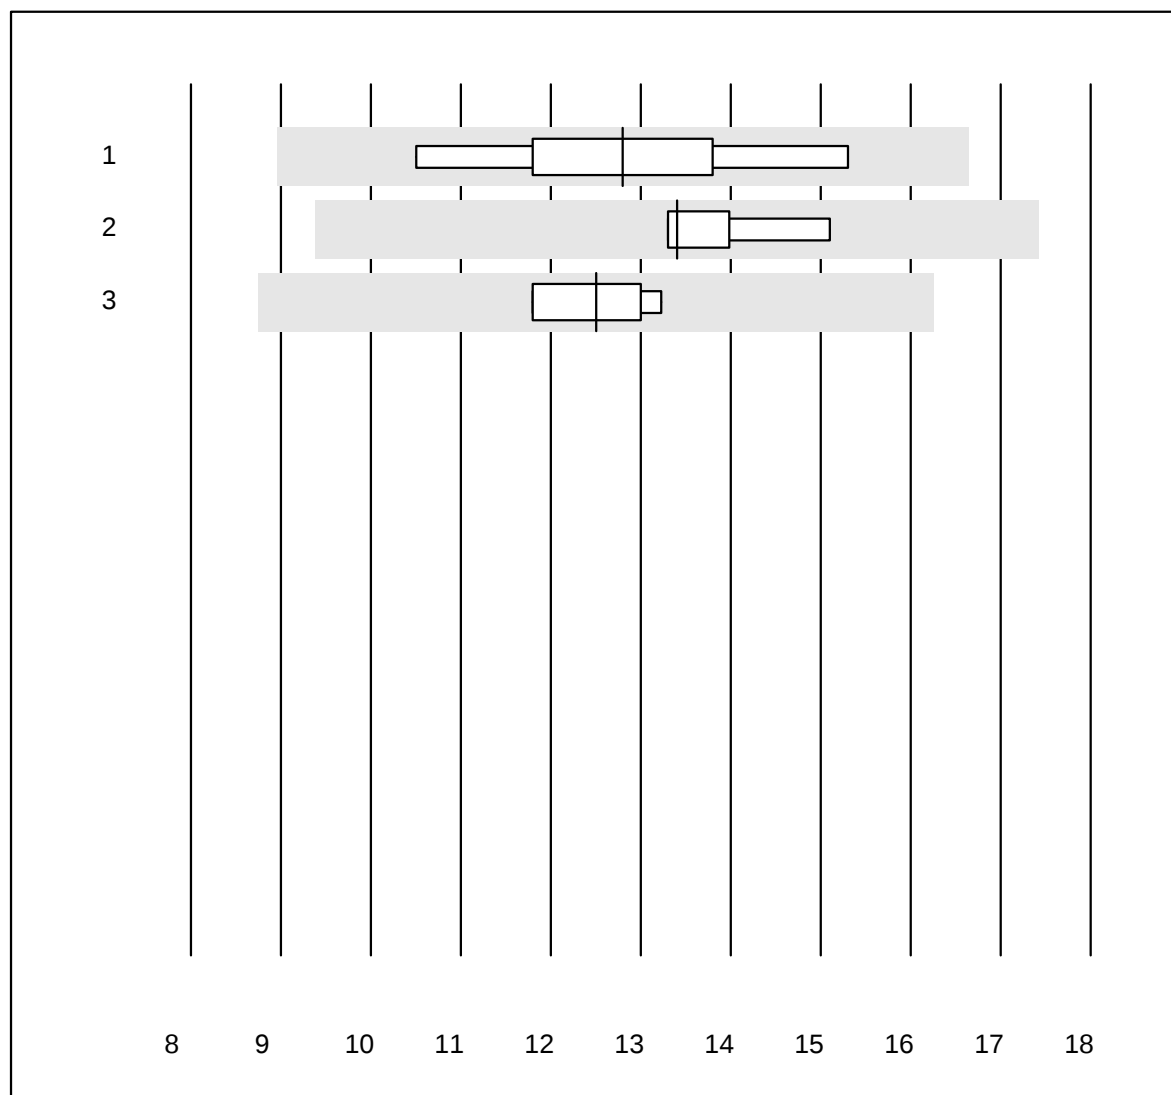


QUALAB Toleranz : 30 %

Testostérone (nmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	12.8	14.3	e*
2	Cobas	5	100.0	0.0	0.0	13.4	5.6	e
3	Architect	4	100.0	0.0	0.0	12.5	5.7	e

Estradiol

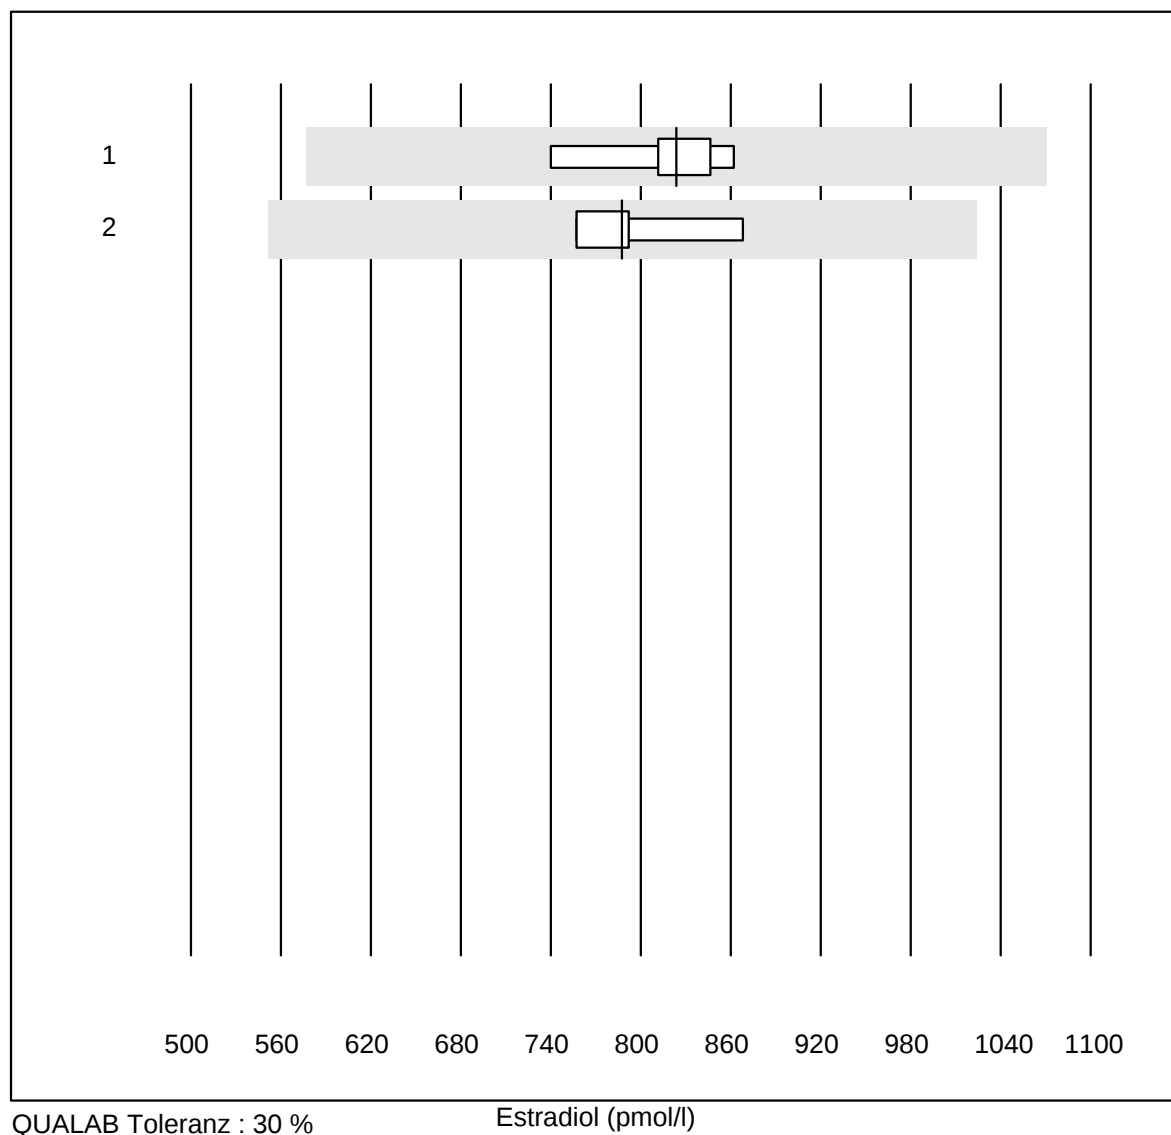


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas	6	100.0	0.0	0.0	824	5.2	e
2	Architect	4	100.0	0.0	0.0	788	6.0	e

SHBG

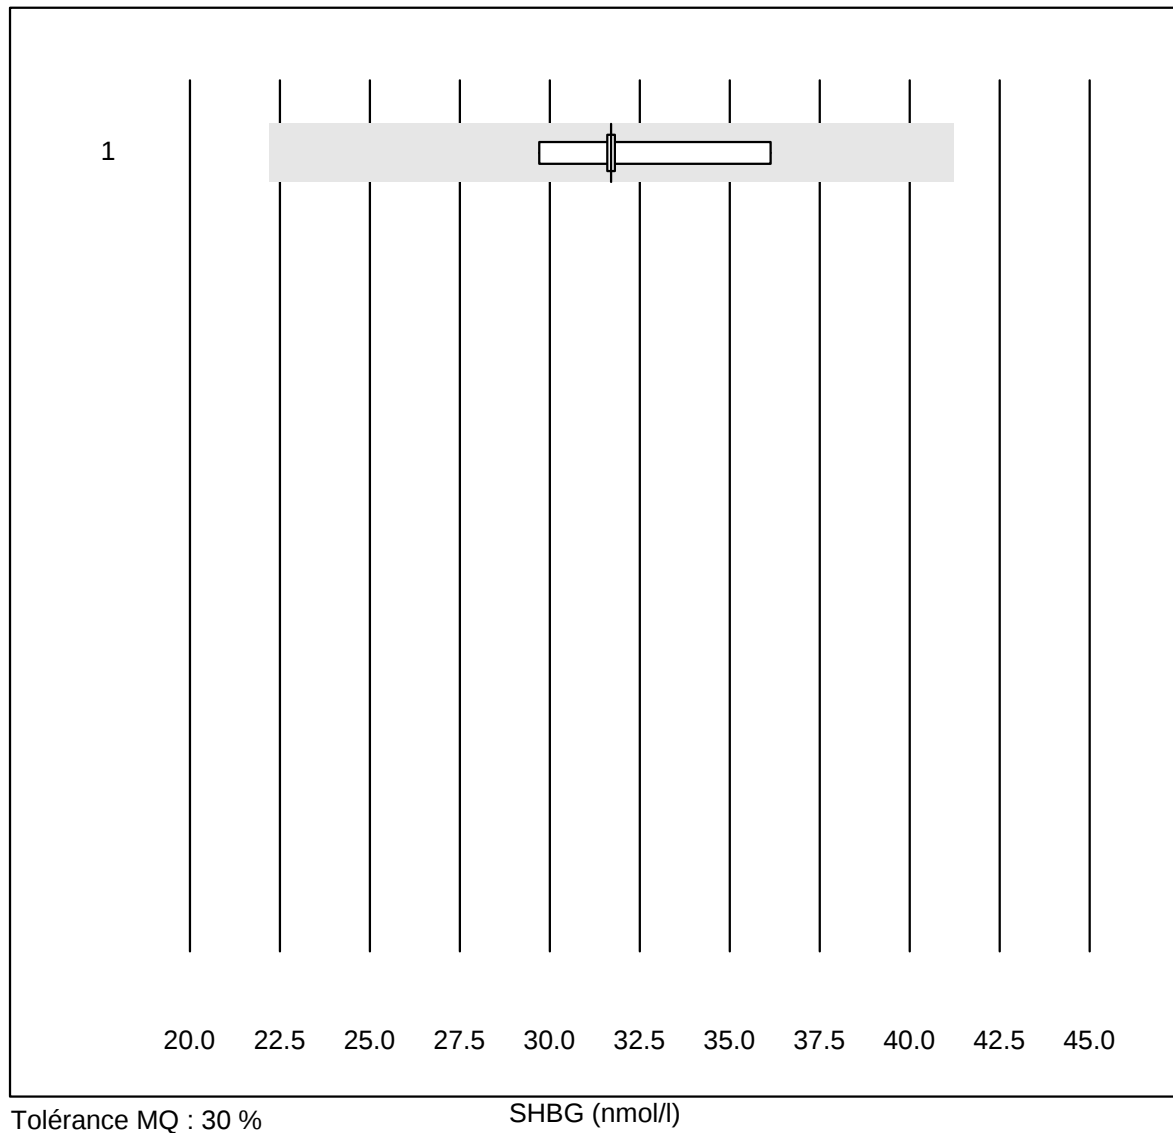


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas	5	100.0	0.0	0.0	31.7	7.4	e

Cortisol

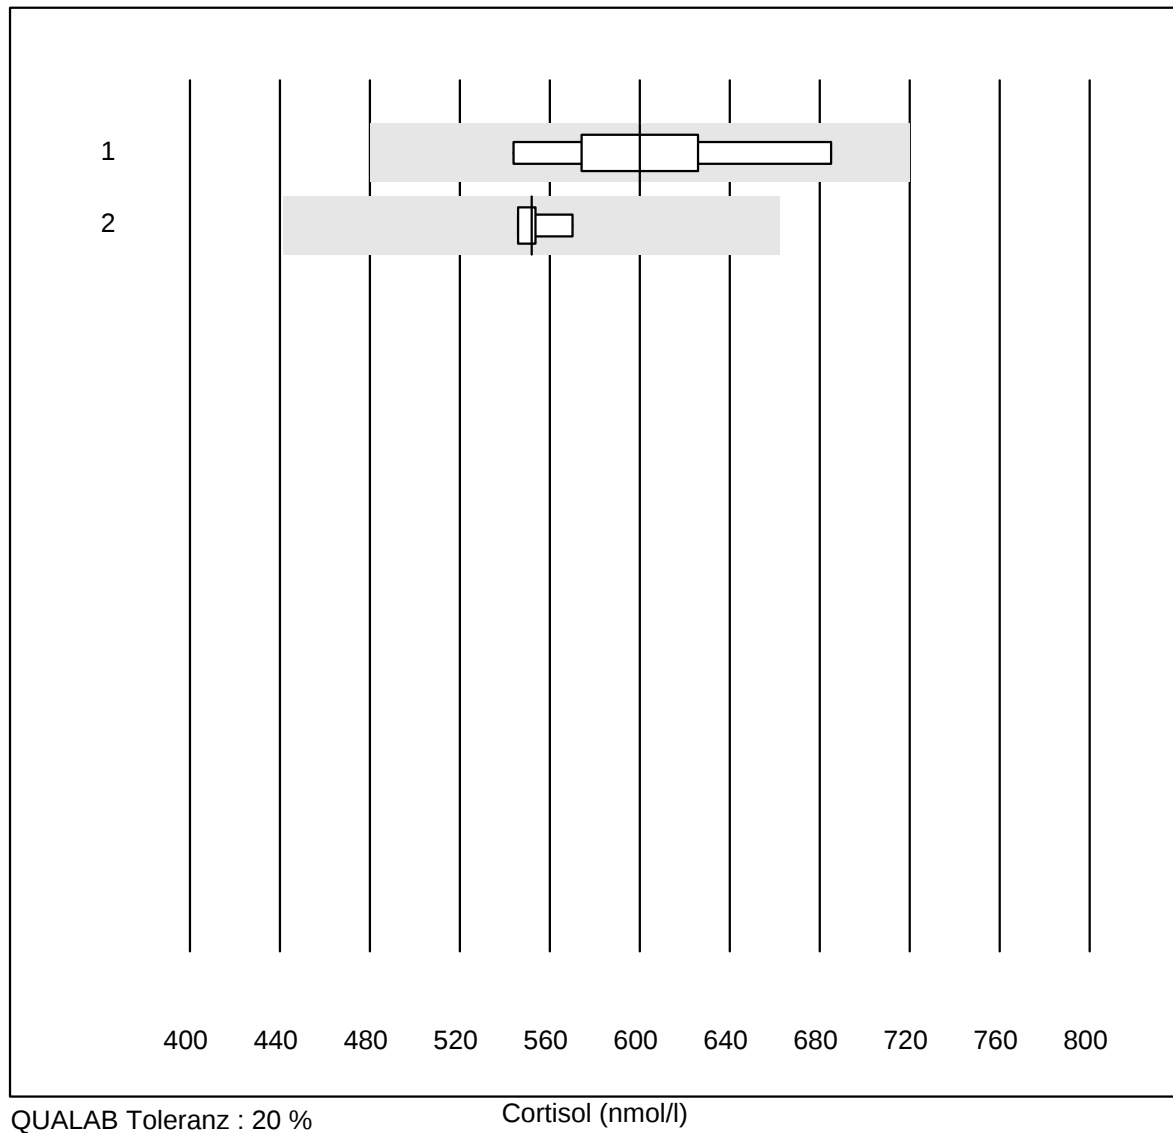


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	8	100.0	0.0	0.0	600	7.2	e*
2	Architect	4	100.0	0.0	0.0	552	1.9	e

DHEAS

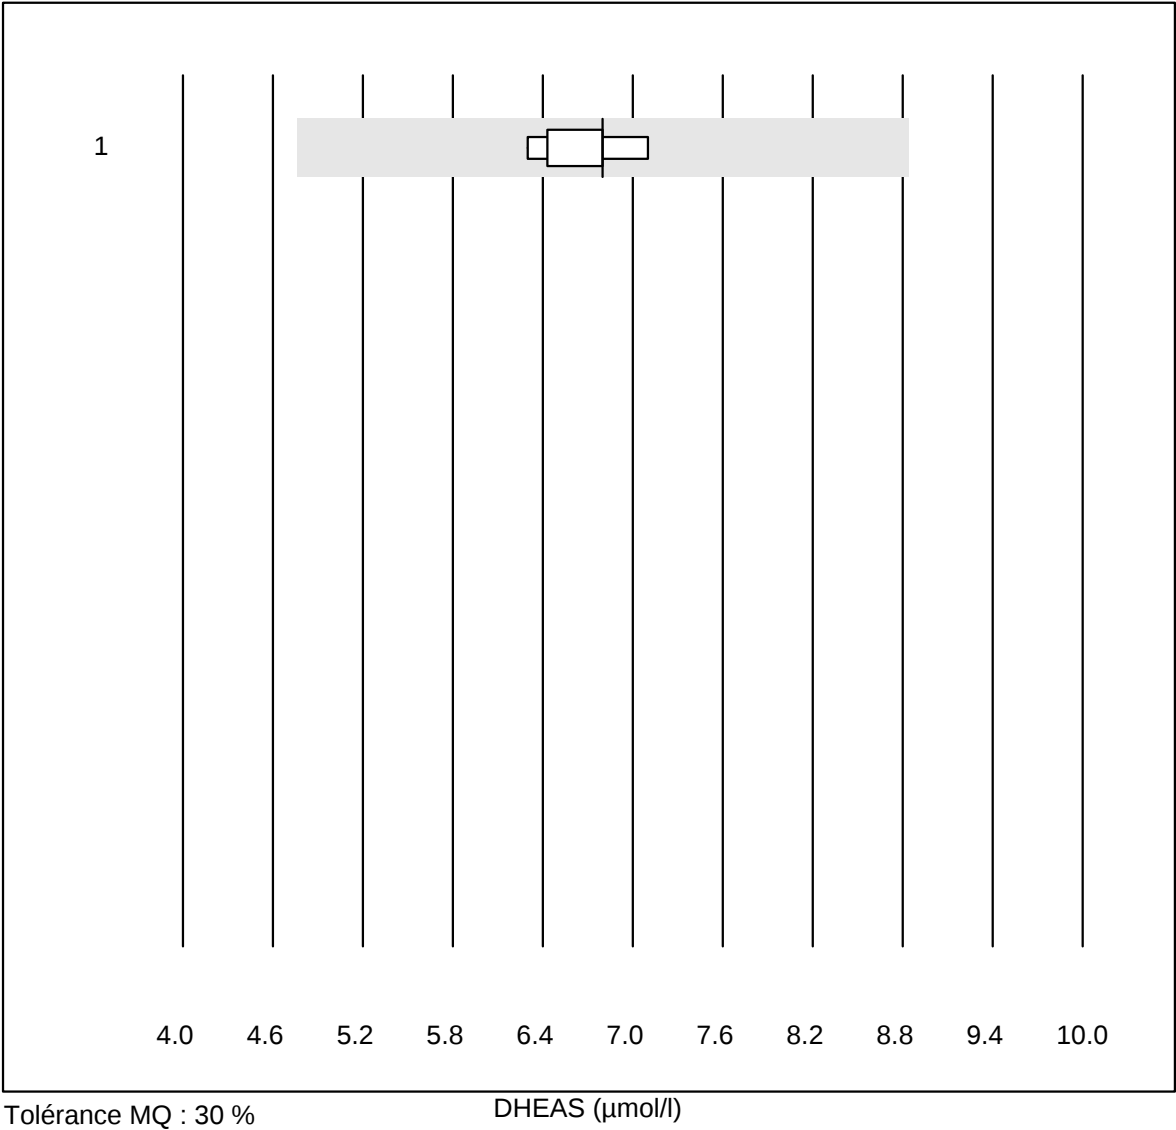

Nr. Methode		Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas	5	100.0	0.0	0.0	6.80	4.8	e

Luteinisierendes Hormon

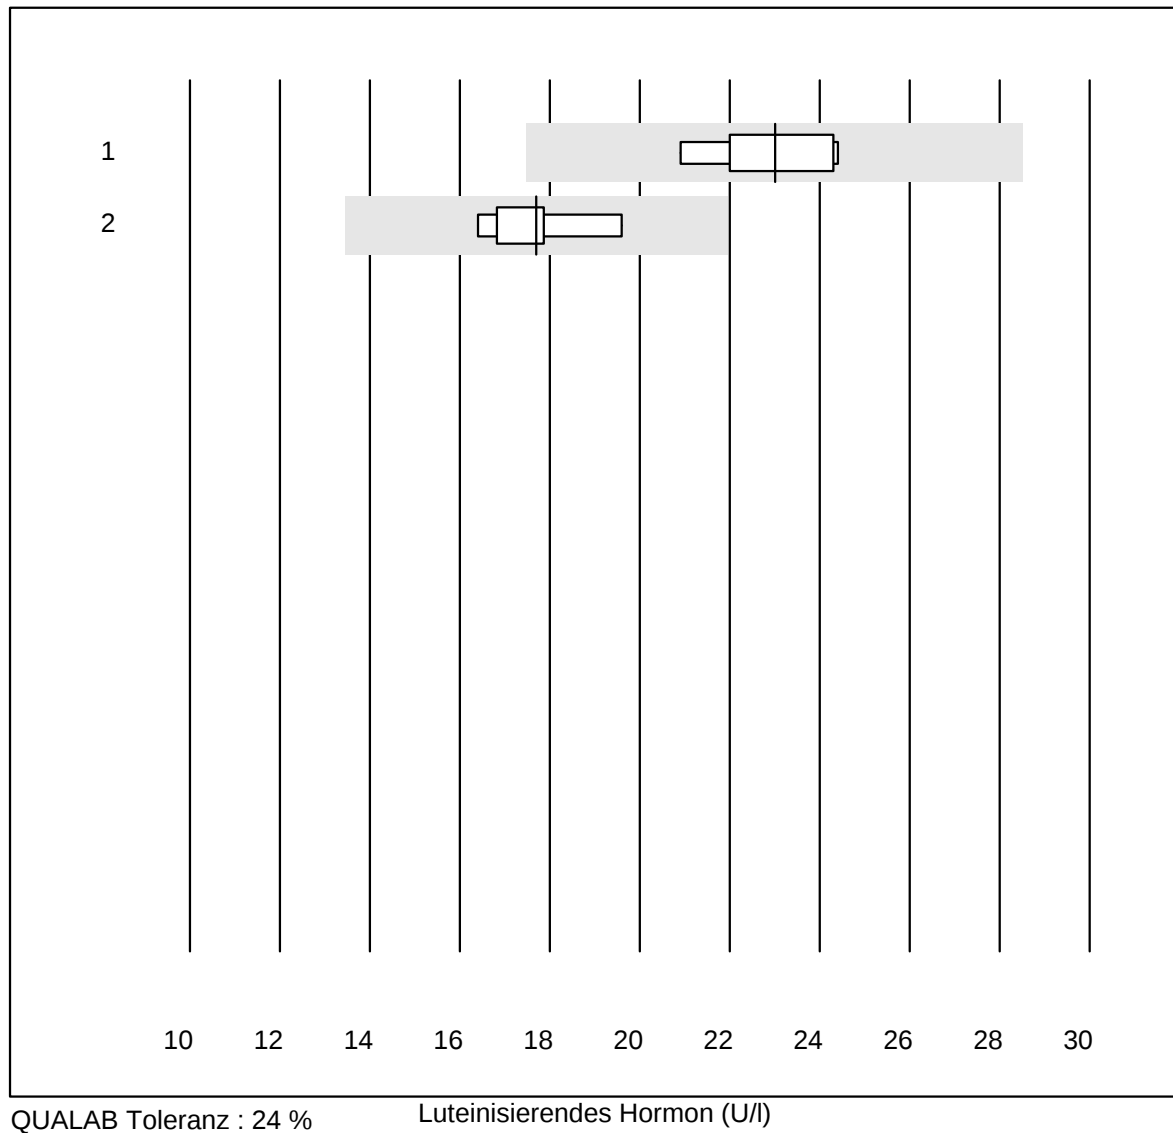


QUALAB Toleranz : 24 %

Luteinisierendes Hormon (U/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Roche, Cobas	7	100.0	0.0	0.0	23.0	5.7	e
2	Architect	5	100.0	0.0	0.0	17.7	7.0	e*

Follikelstimulierendes Hormon

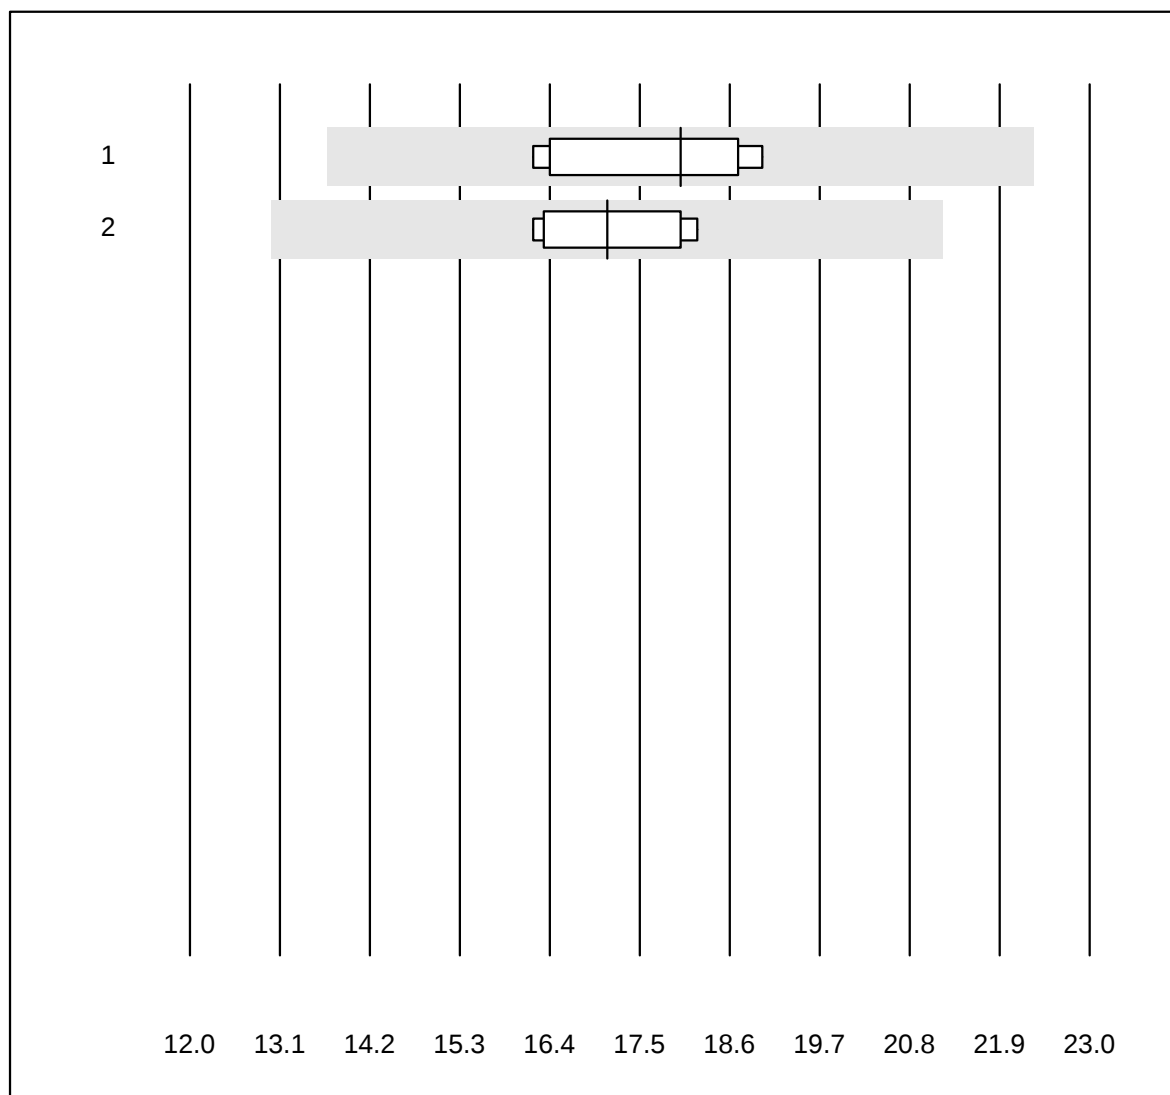


QUALAB Toleranz : 24 %

Follikelstimulierendes Hormon (U/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Roche, Cobas	7	100.0	0.0	0.0	18.0	6.0	e
2	Architect	6	100.0	0.0	0.0	17.1	5.0	e

Prolaktin (PRL)

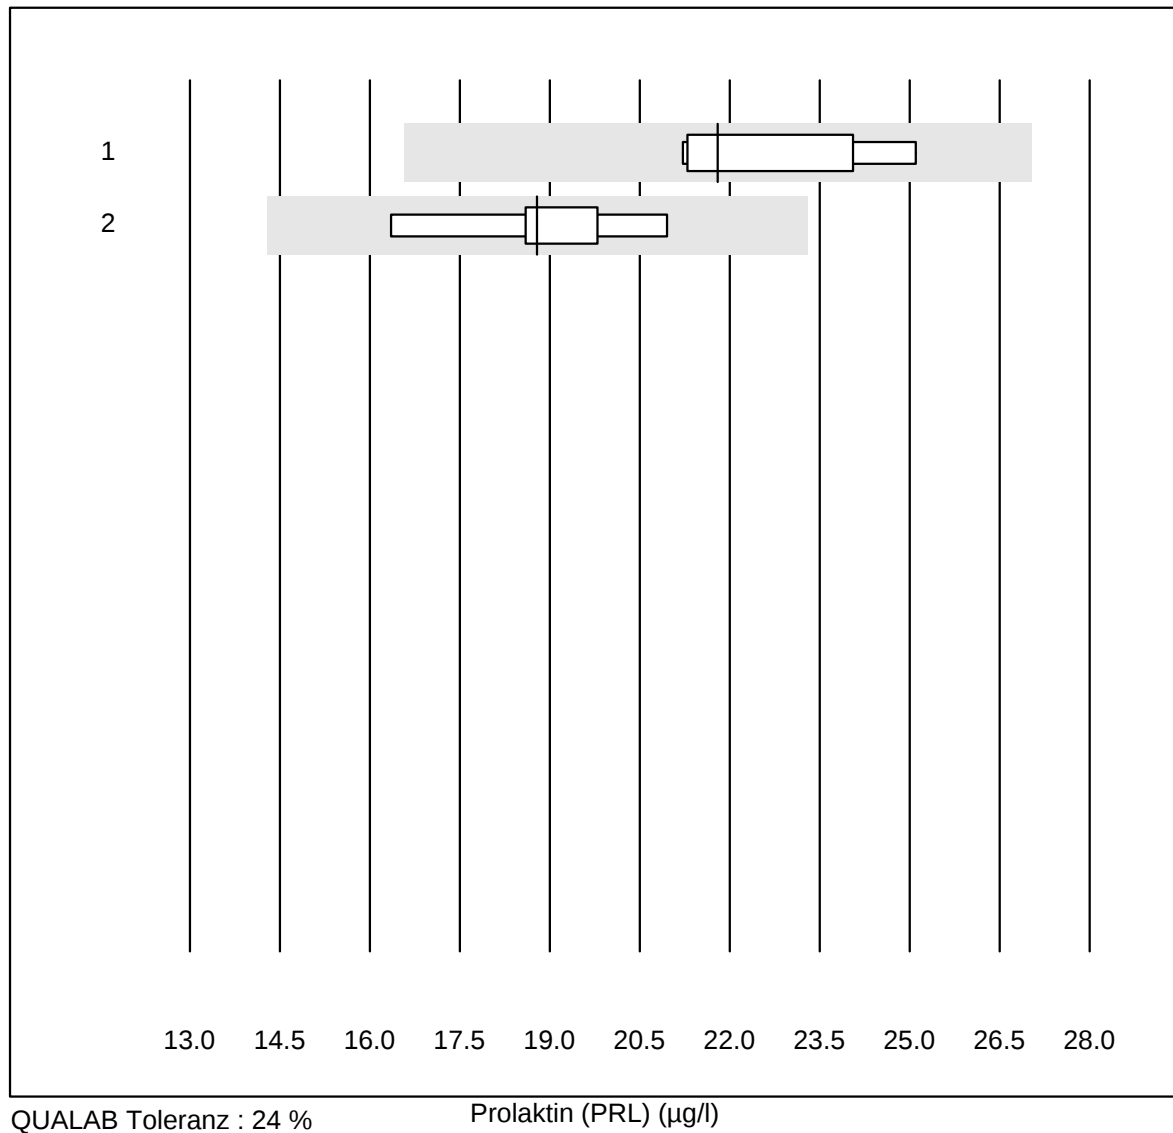


QUALAB Toleranz : 24 %


Prolaktin (PRL) (µg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas/Roche	7	100.0	0.0	0.0	21.8	6.7	e
2	Architect	5	100.0	0.0	0.0	18.8	9.0	e*

HGH

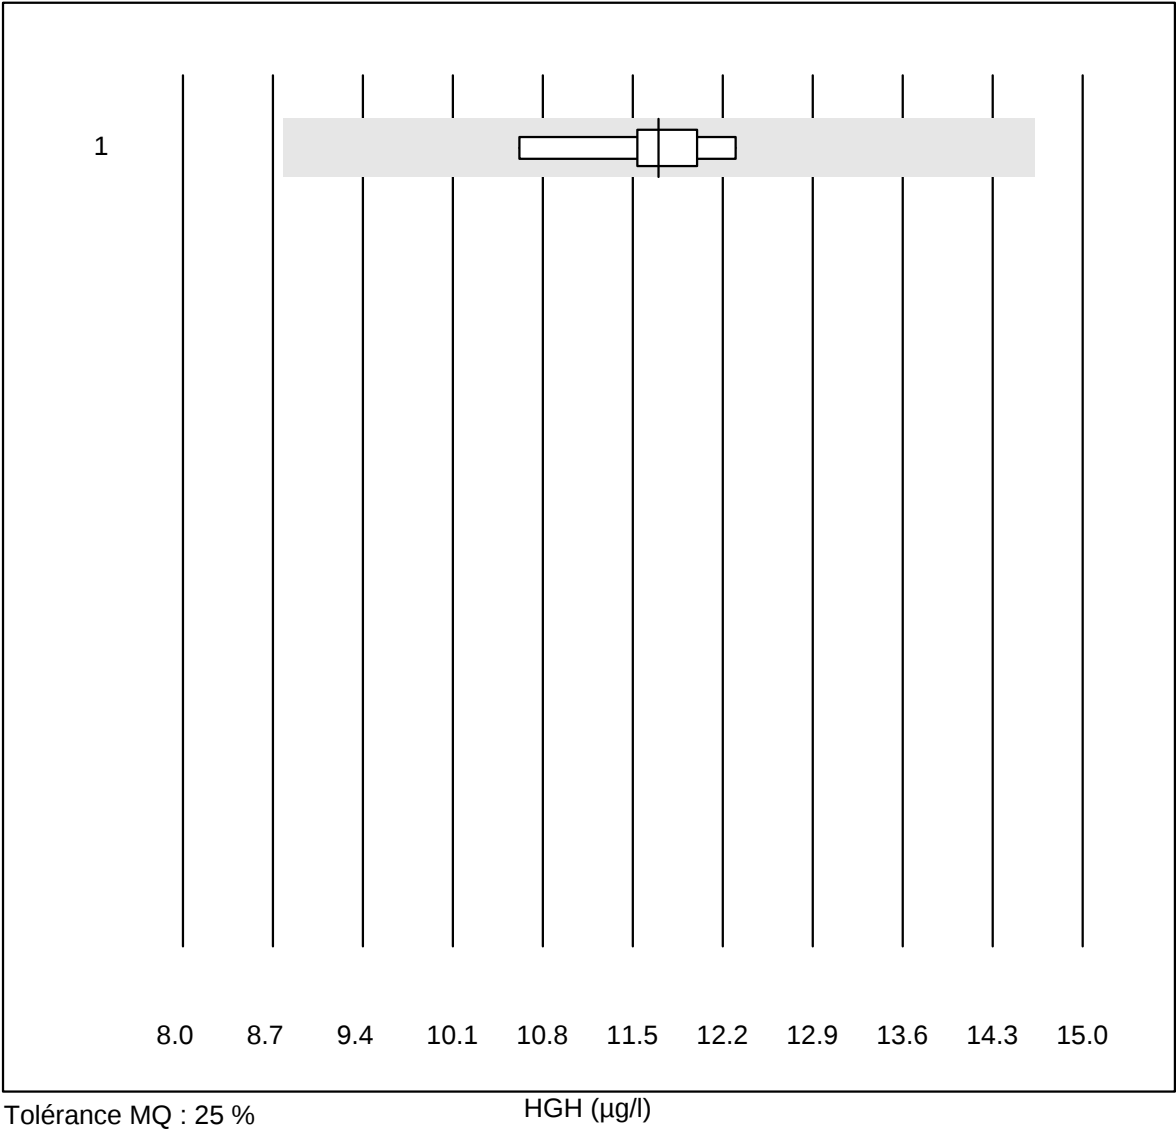


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	11.70	4.9	e

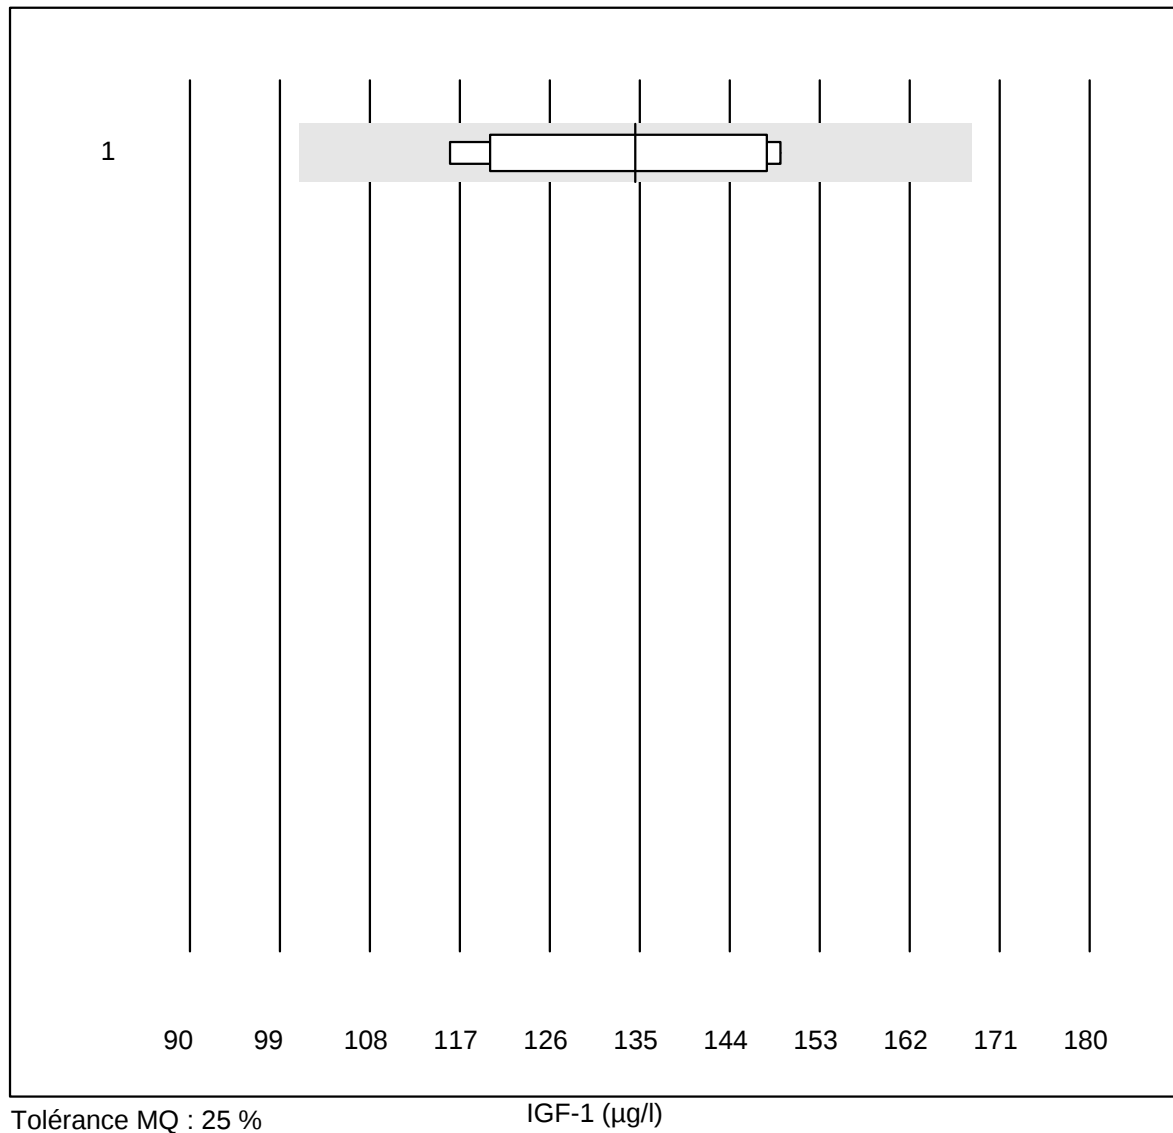IGF-1


Nr.	Methode	Total	% E fulfil	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Liaison	6	100.0	0.0	0.0	135	10.4	a

Troponine T CR

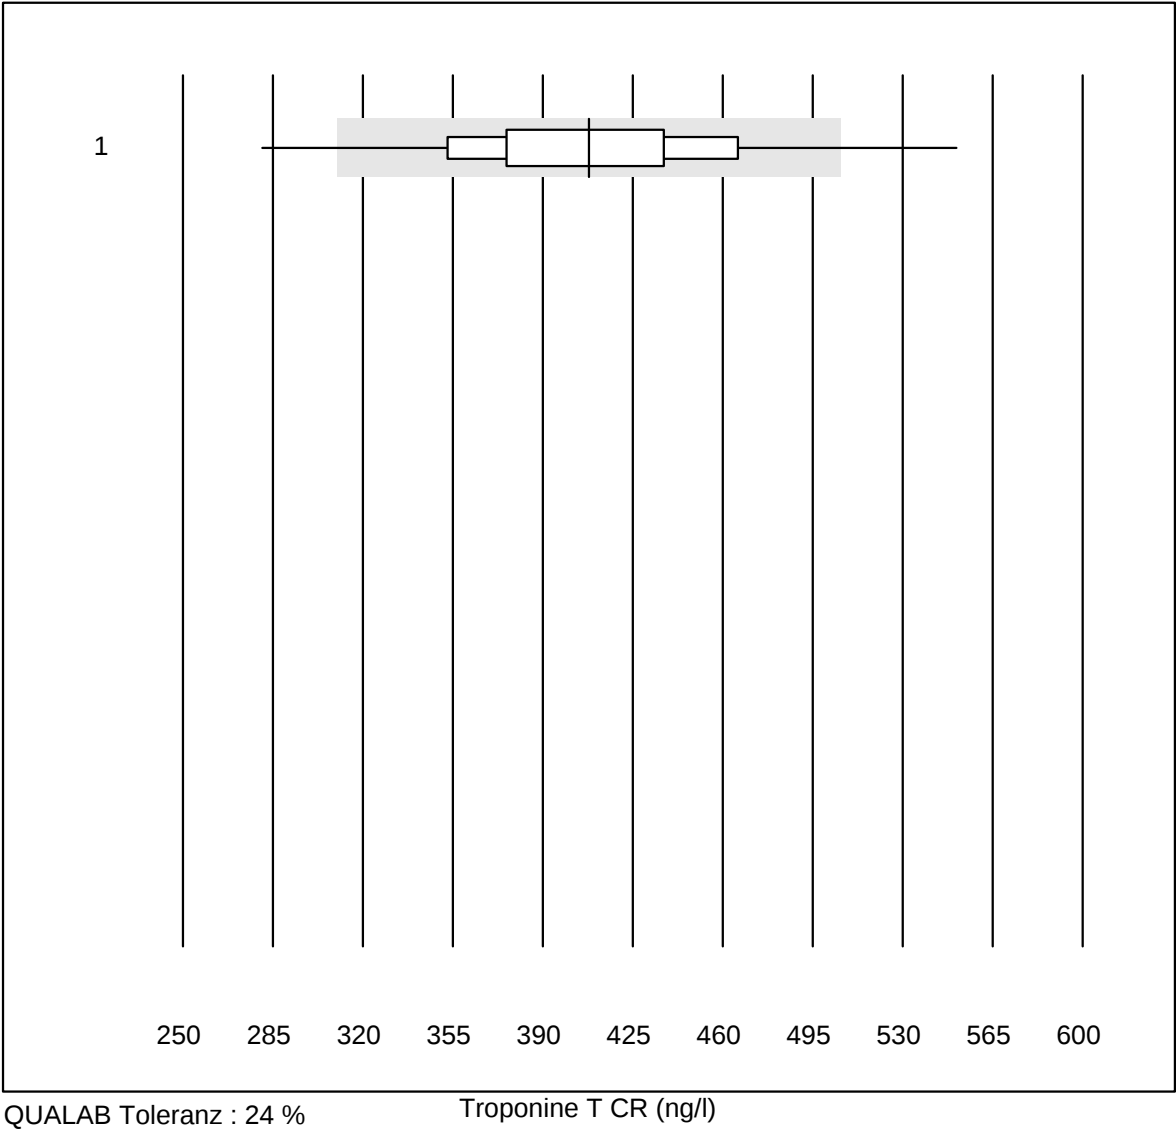


Nr. Methode		Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas h 232	1277	97.1	2.5	0.4	407.93	10.8	e

D-Dimères CR

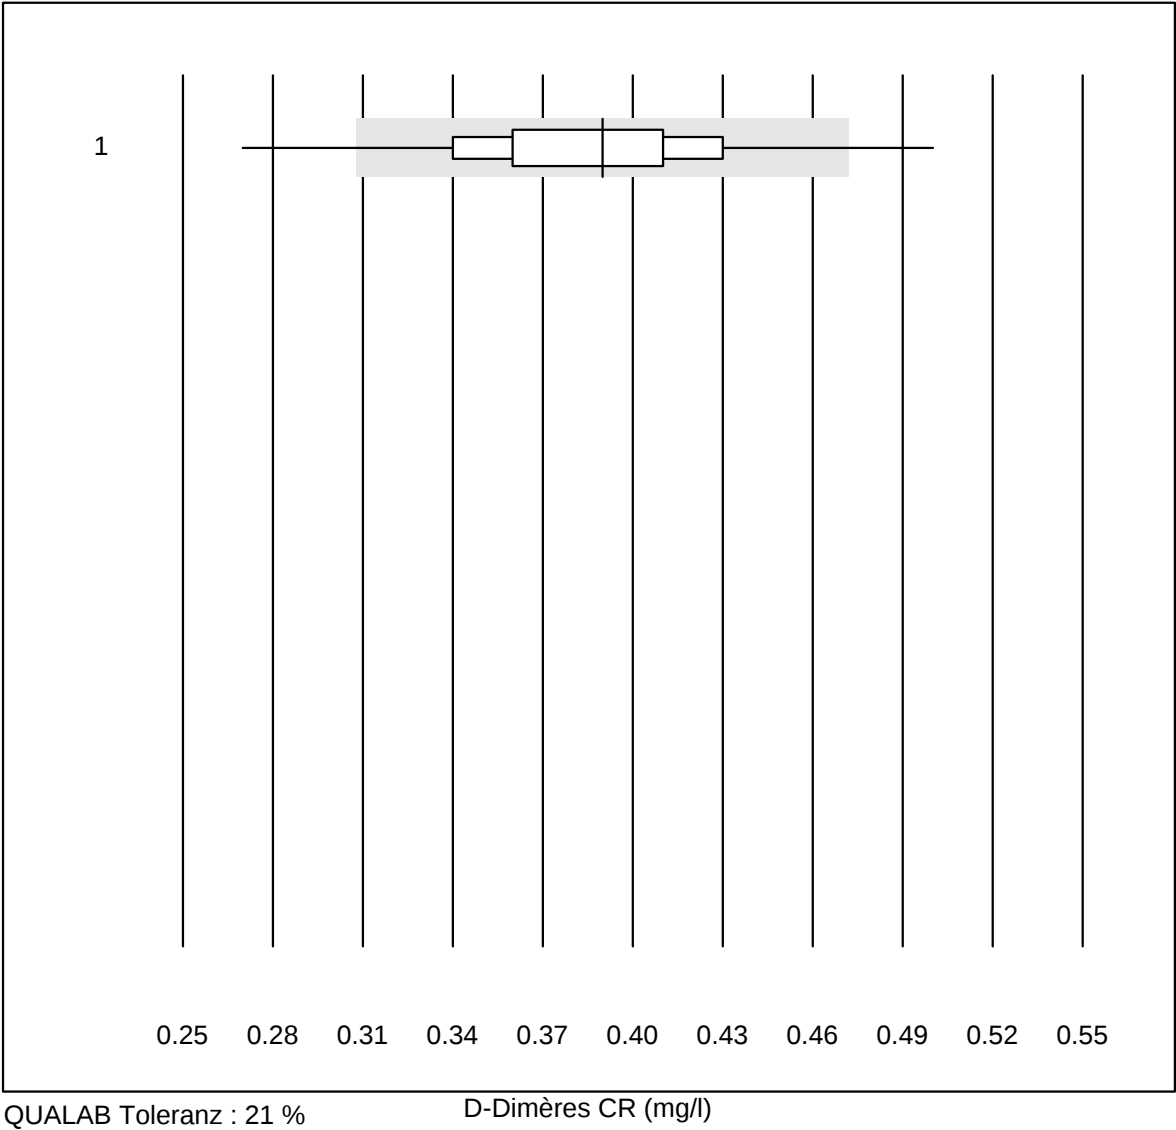


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas h 232	1263	96.4	3.1	0.5	0.39	9.4	e

CKMB- K8

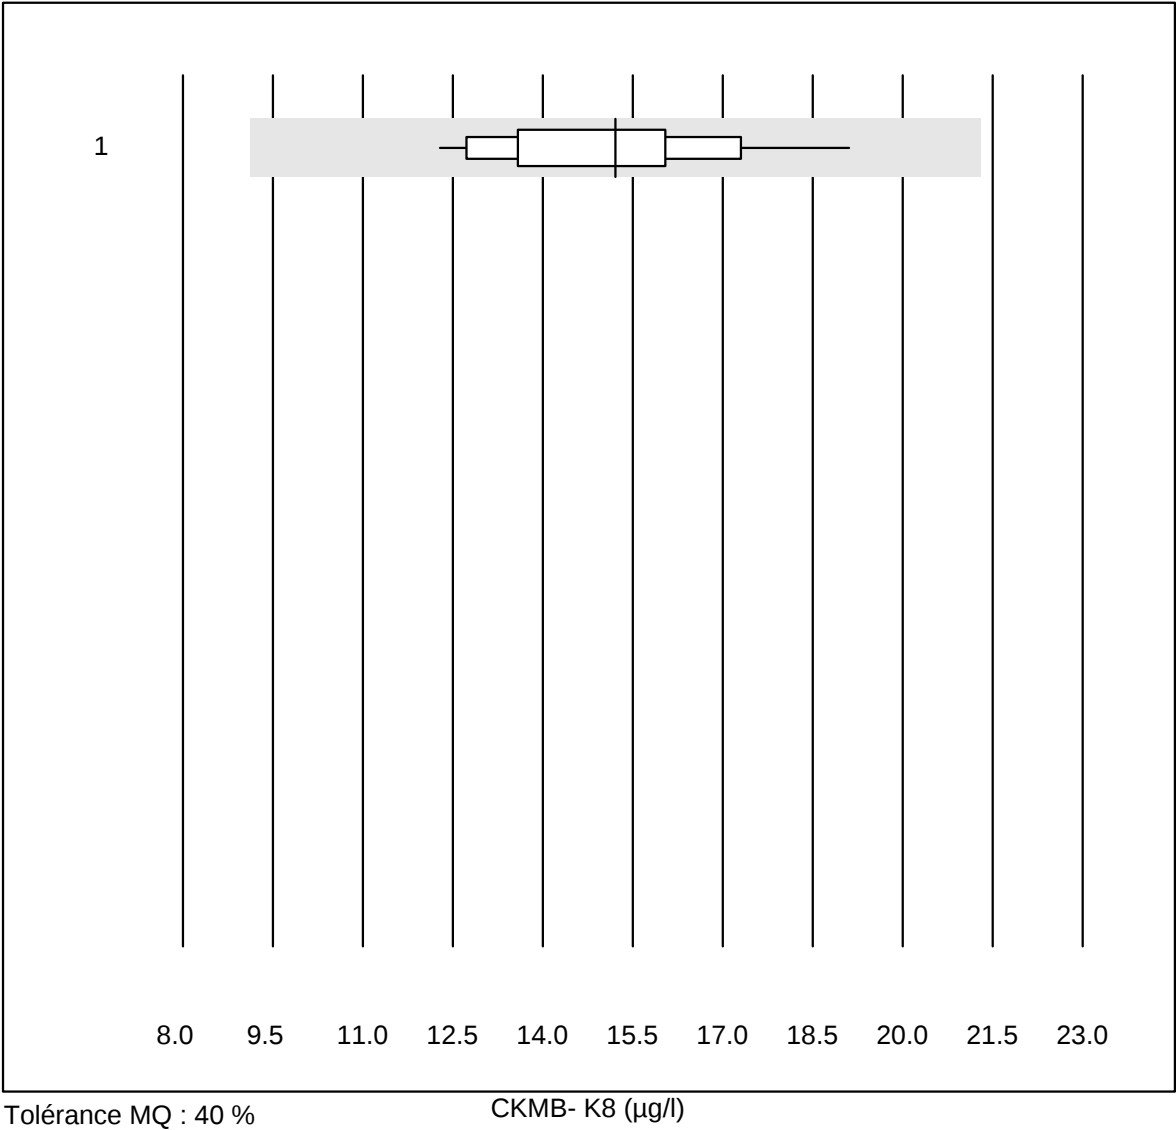


Nr. Methode		Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas h 232	13	100.0	0.0	0.0	15.2	12.7	e


NT-proBNP CR

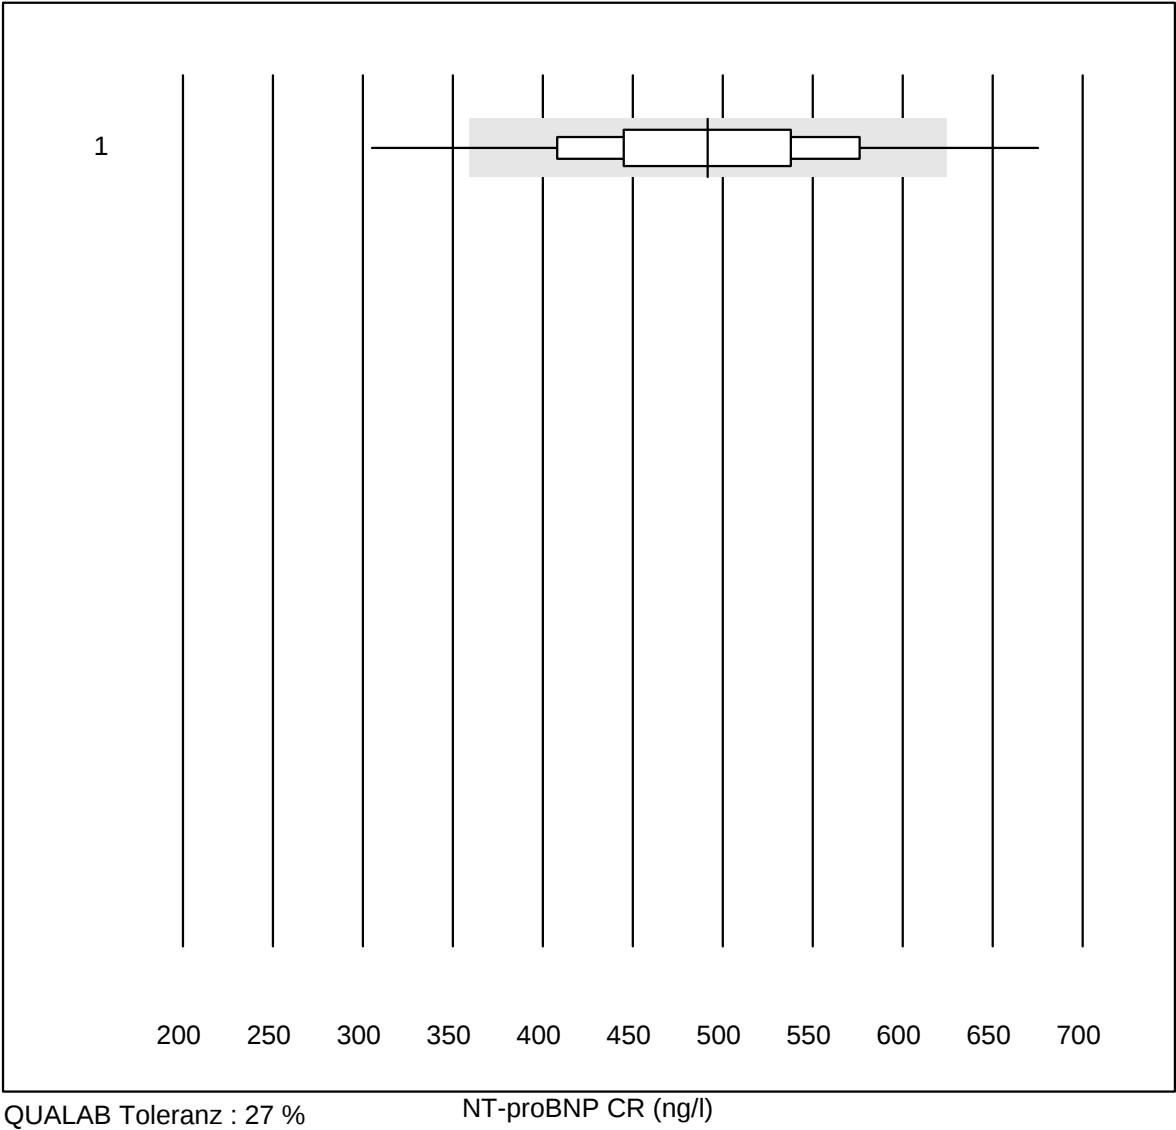

Nr. Methode		Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas h 232	818	96.8	2.6	0.6	492	13.0	e

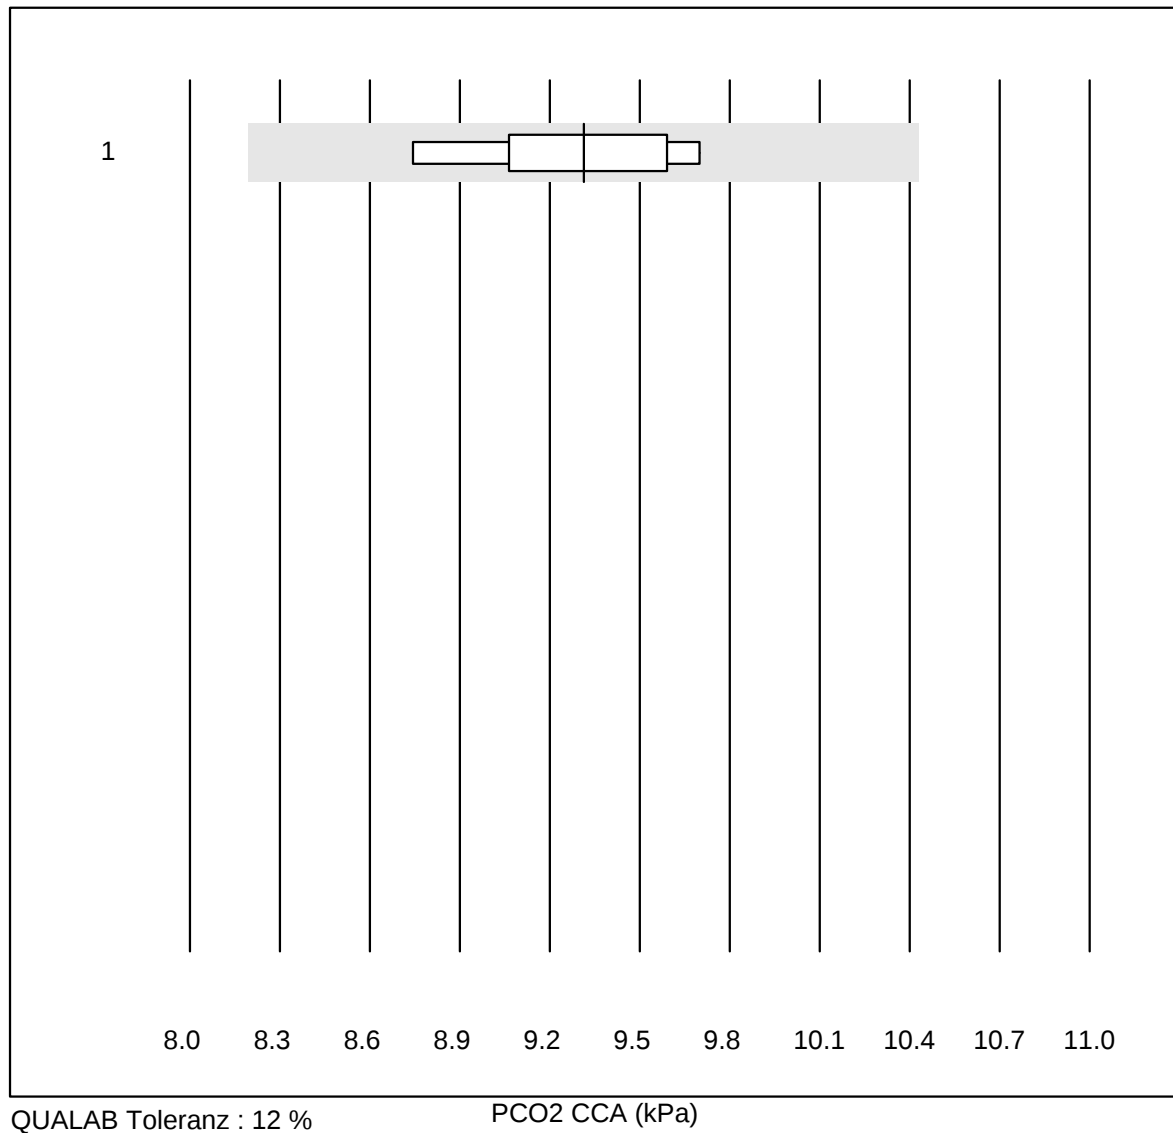
PCO2 CCA

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	OPTI CCA	10	100.0	0.0	0.0	9.31	3.6	e

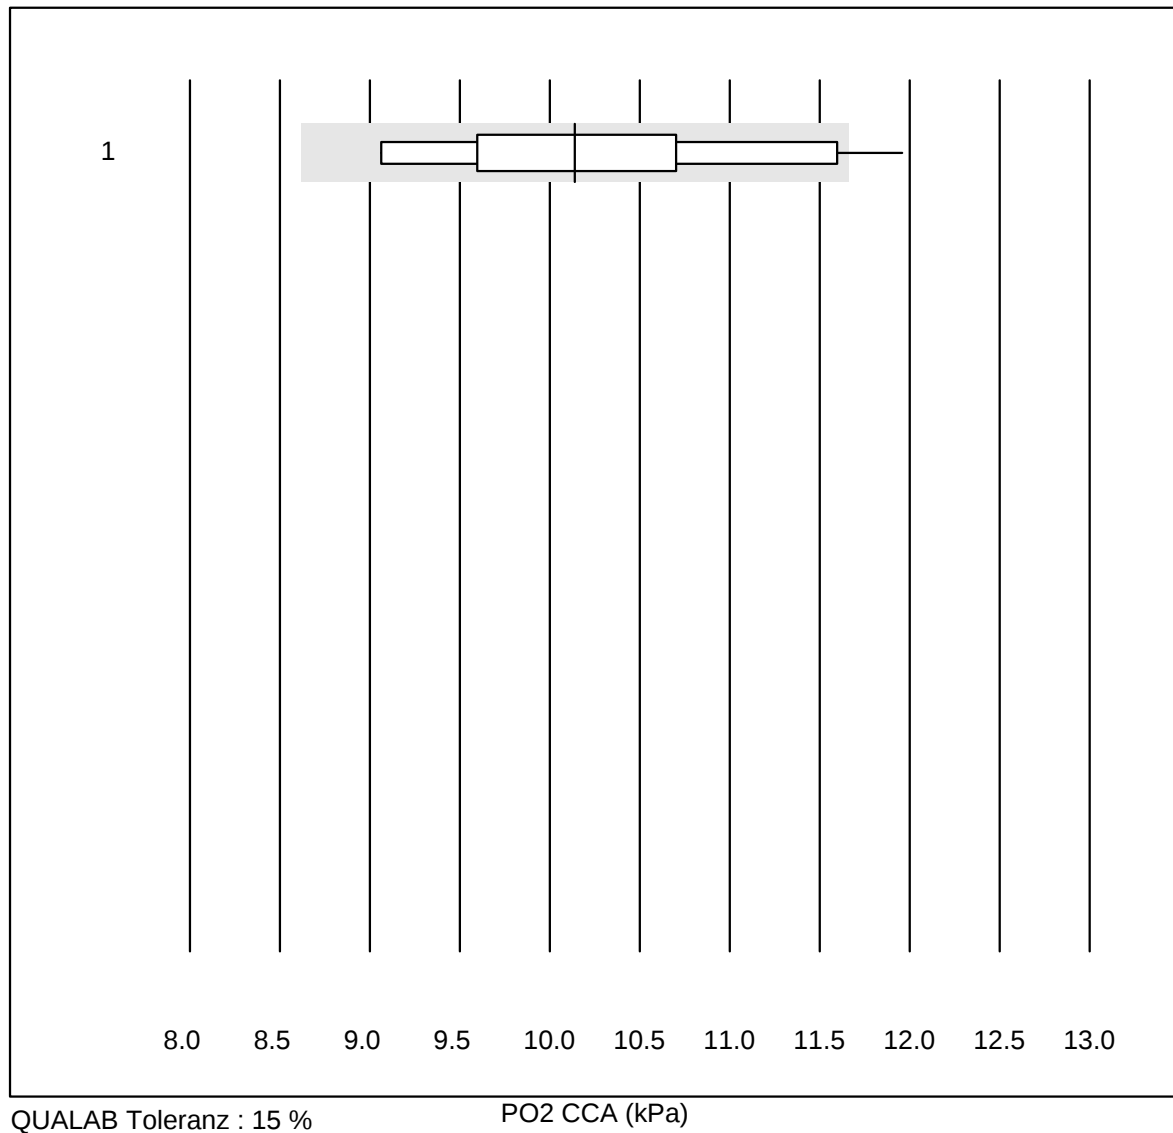PO2 CCA


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	OPTI CCA	10	90.0	10.0	0.0	10.14	9.7	e*

pH CCA

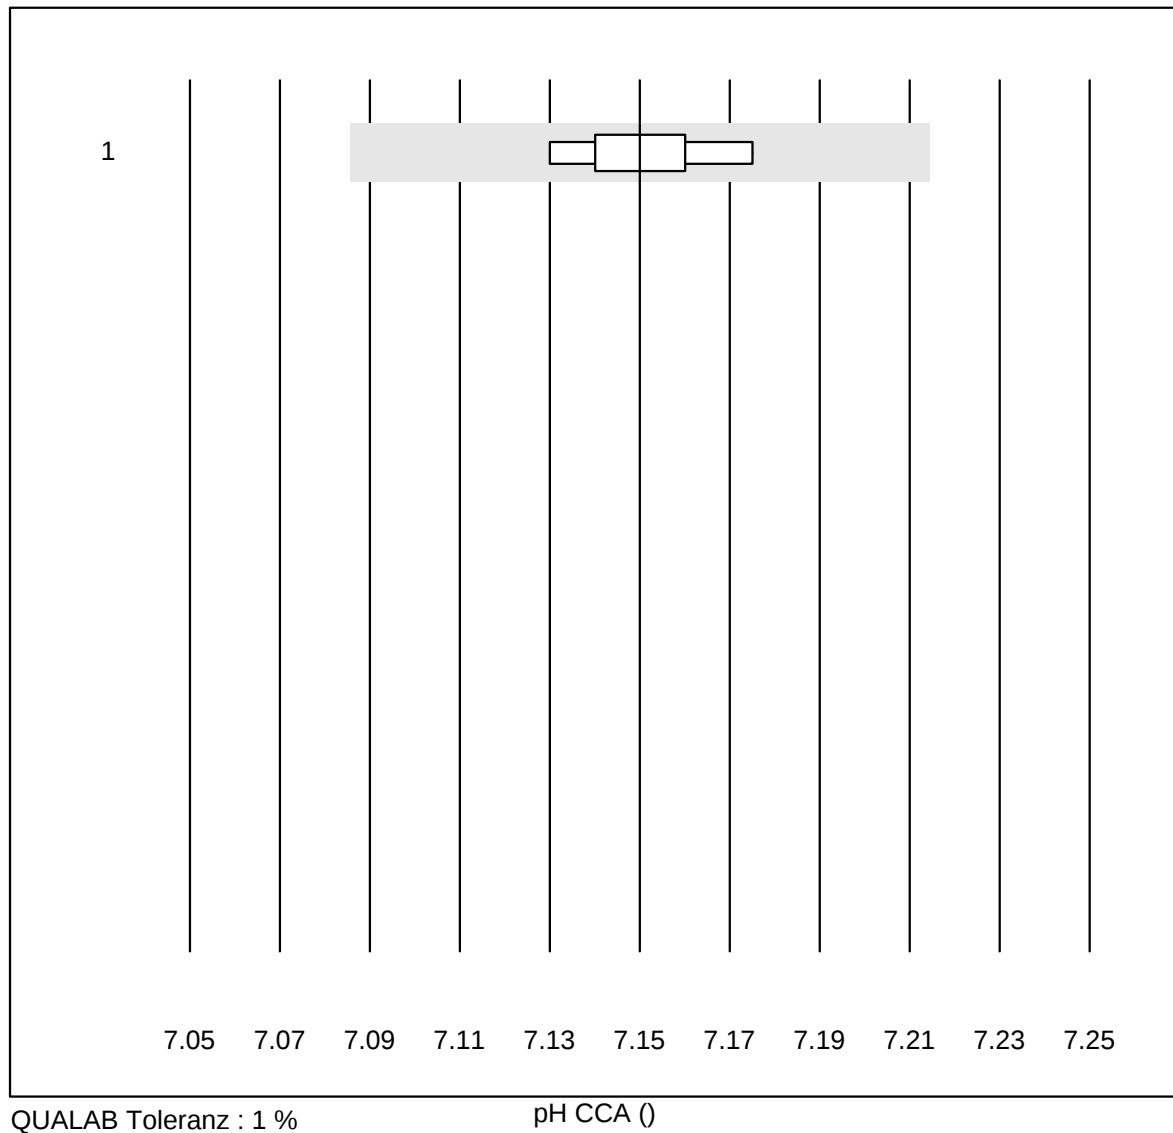

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 OPTI CCA	9	100.0	0.0	0.0	7.15	0.2	e

Potassium CCA

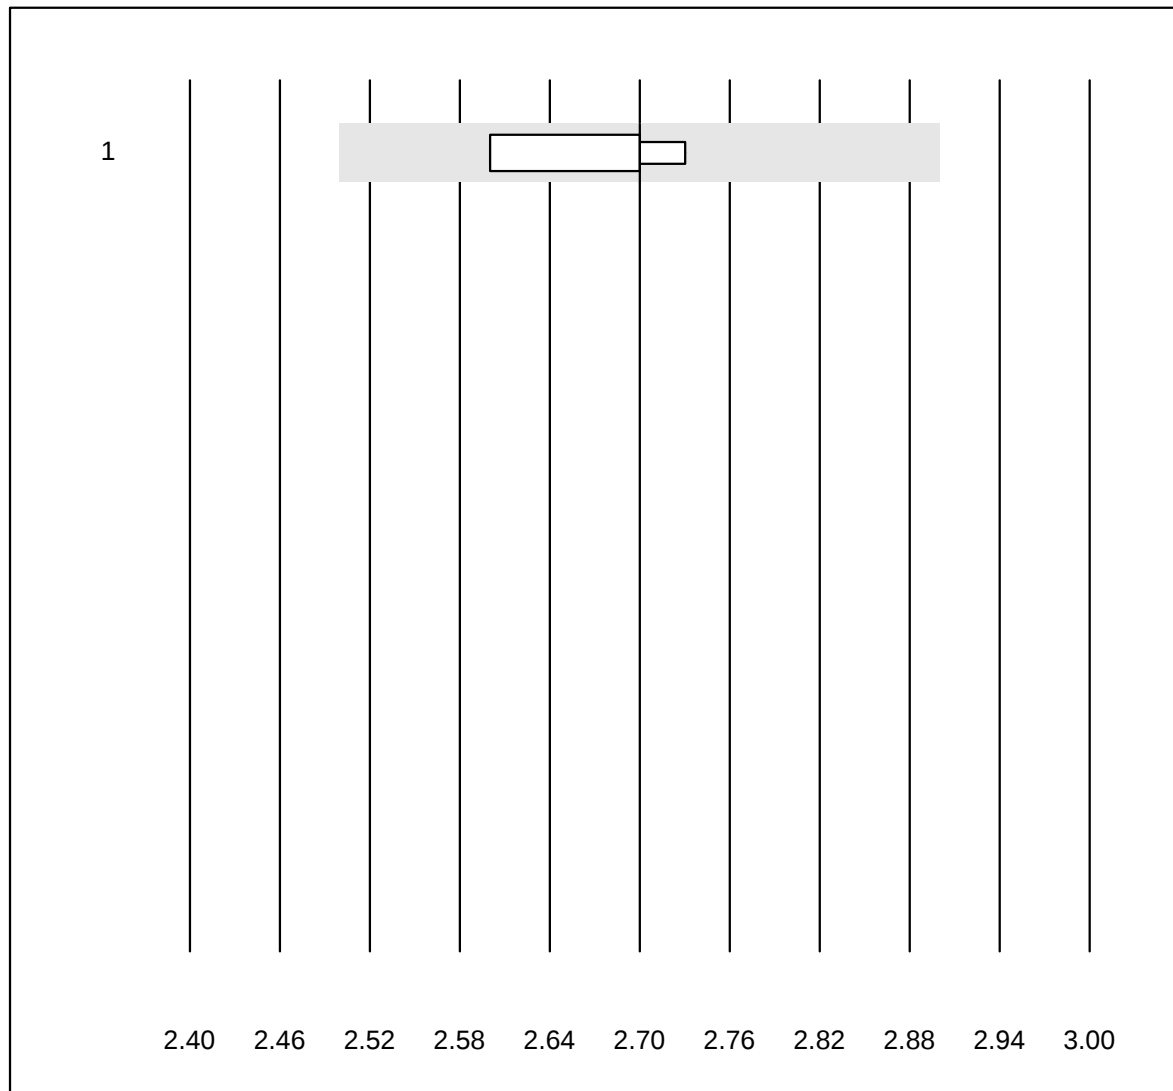


QUALAB Toleranz : 6 %
(< 3.3: +/- 0.2 mmol/l)

Potassium CCA (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 OPTI CCA	4	100.0	0.0	0.0	2.7	2.1	e*

Ferritine

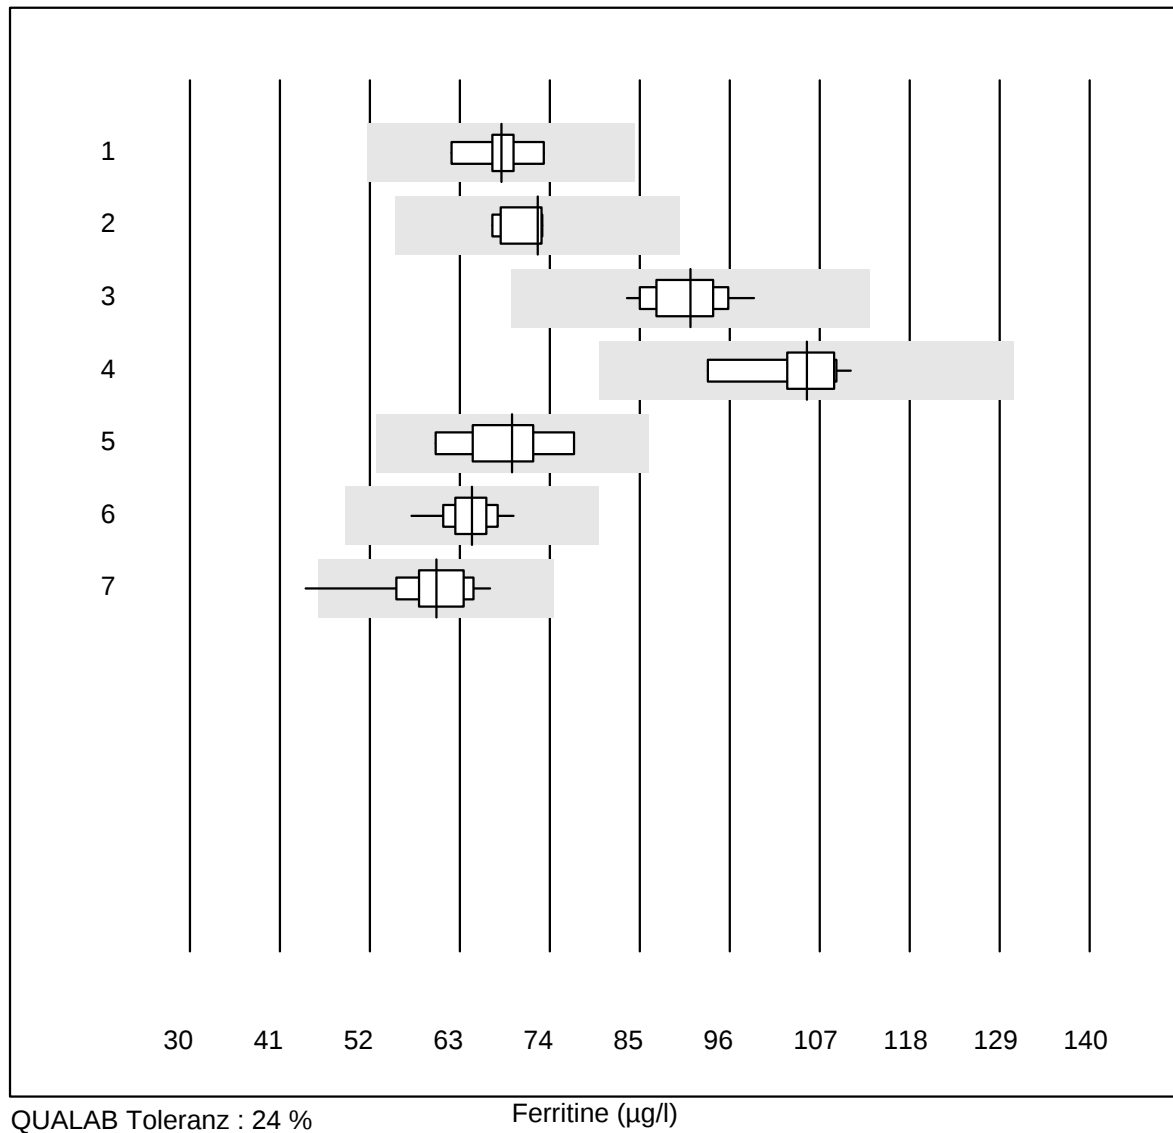


QUALAB Toleranz : 24 %

Ferritine (µg/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Beckman	7	100.0	0.0	0.0	68.10	5.0	e
2	toutes les méthodes	6	83.3	0.0	16.7	72.50	4.1	e
3	Cobas E / Elecsys	15	100.0	0.0	0.0	91.23	4.7	e
4	Architect	10	100.0	0.0	0.0	105.43	4.9	e
5	Mini Vidas	9	100.0	0.0	0.0	69.41	8.7	e*
6	AFIAS	47	100.0	0.0	0.0	64.50	3.9	e
7	Eurolyser	20	90.0	5.0	5.0	60.12	8.1	e

Vitamine B12

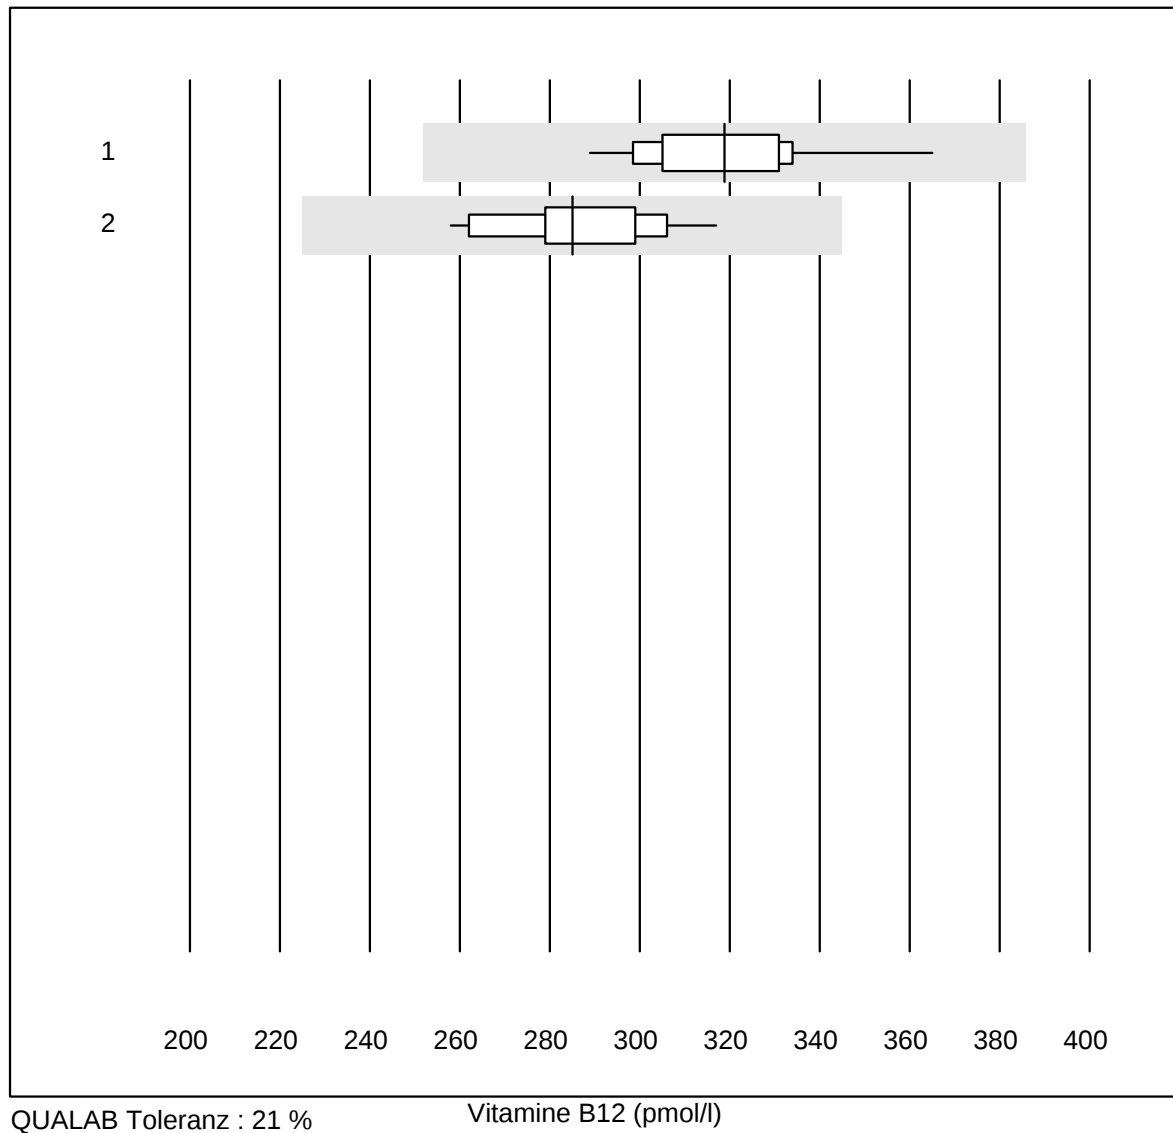

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	13	100.0	0.0	0.0	318.87	6.1	e
2	Architect	13	100.0	0.0	0.0	284.97	6.0	e

Folate

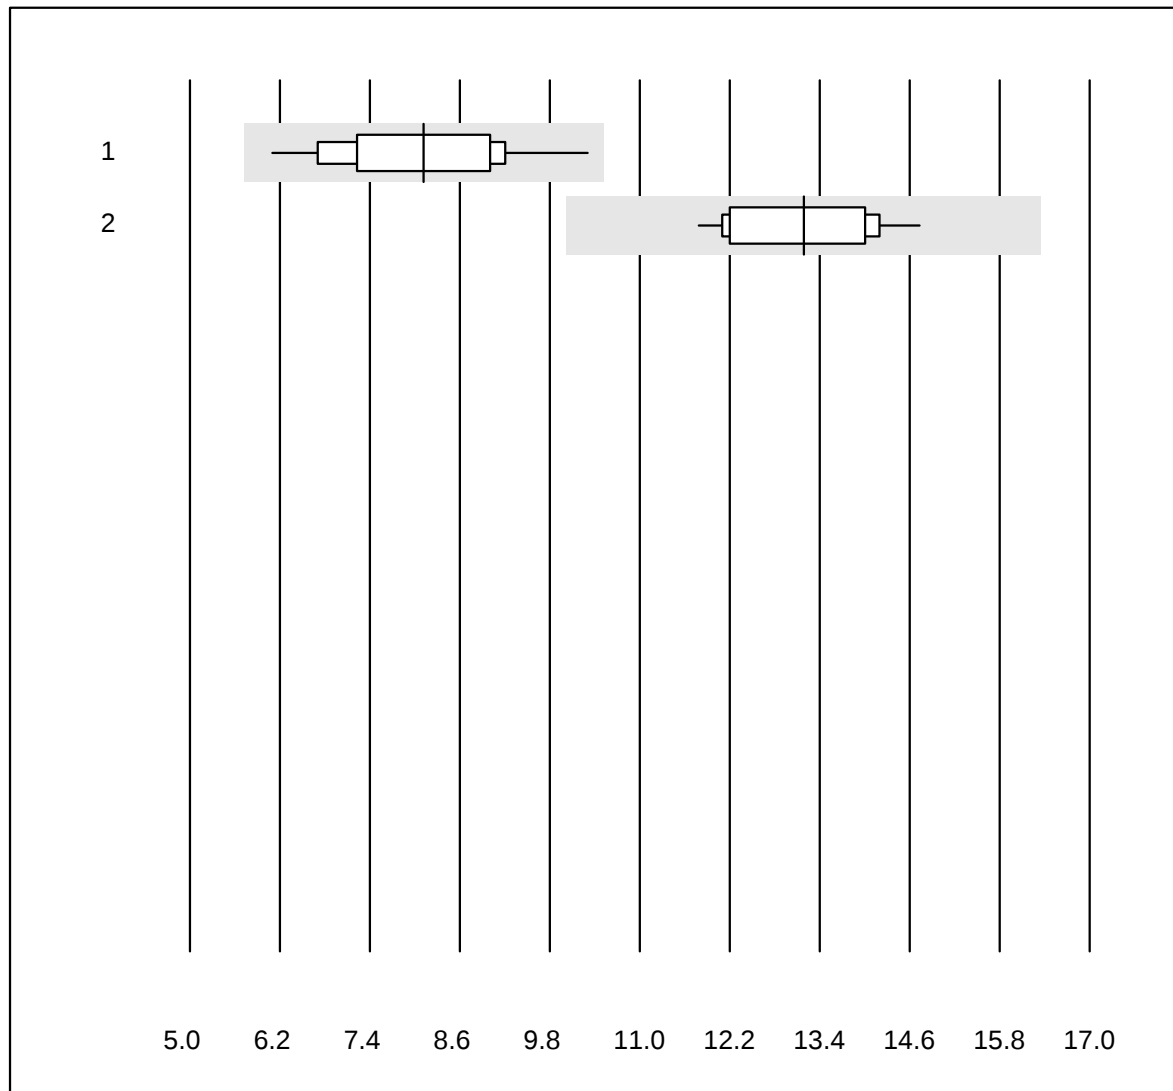


QUALAB Toleranz : 24 %
(< 10.00: +/- 2.40 nmol/l)

Folate (nmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	14	100.0	0.0	0.0	8.12	14.7	e*
2	Architect	11	100.0	0.0	0.0	13.19	7.2	e

Holotranscobalamine

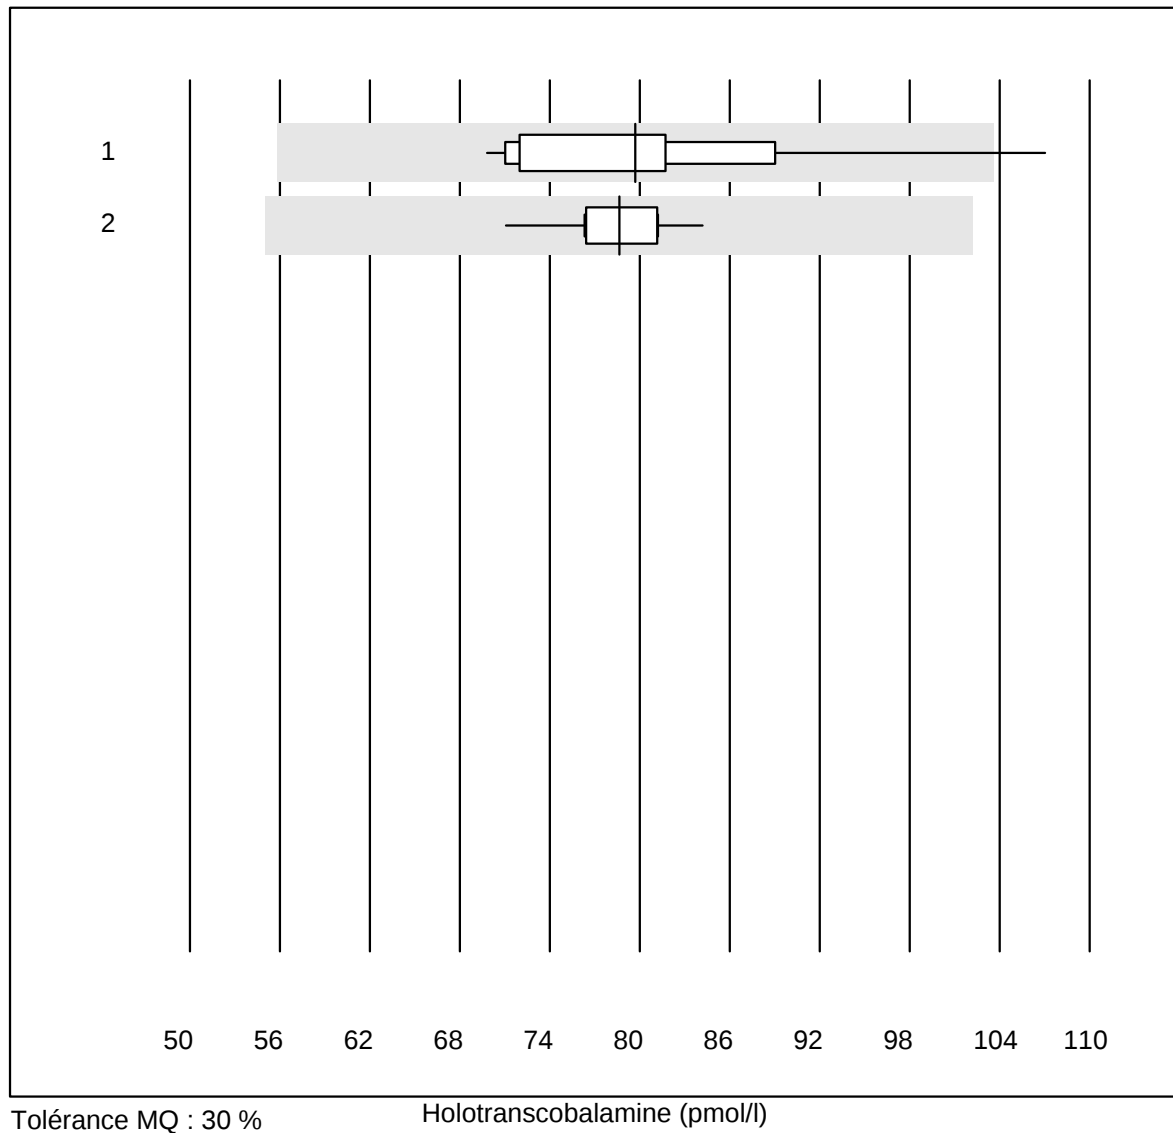


Tolérance MQ : 30 %

Holotranscobalamine (pmol/l)


Nr.	Methode	Total	% E fulfil	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Architect	13	76.9	7.7	15.4	79.7	13.4	e*
2	toutes les méthodes	13	84.6	0.0	15.4	78.7	4.3	e

Bilirubin totale Neo

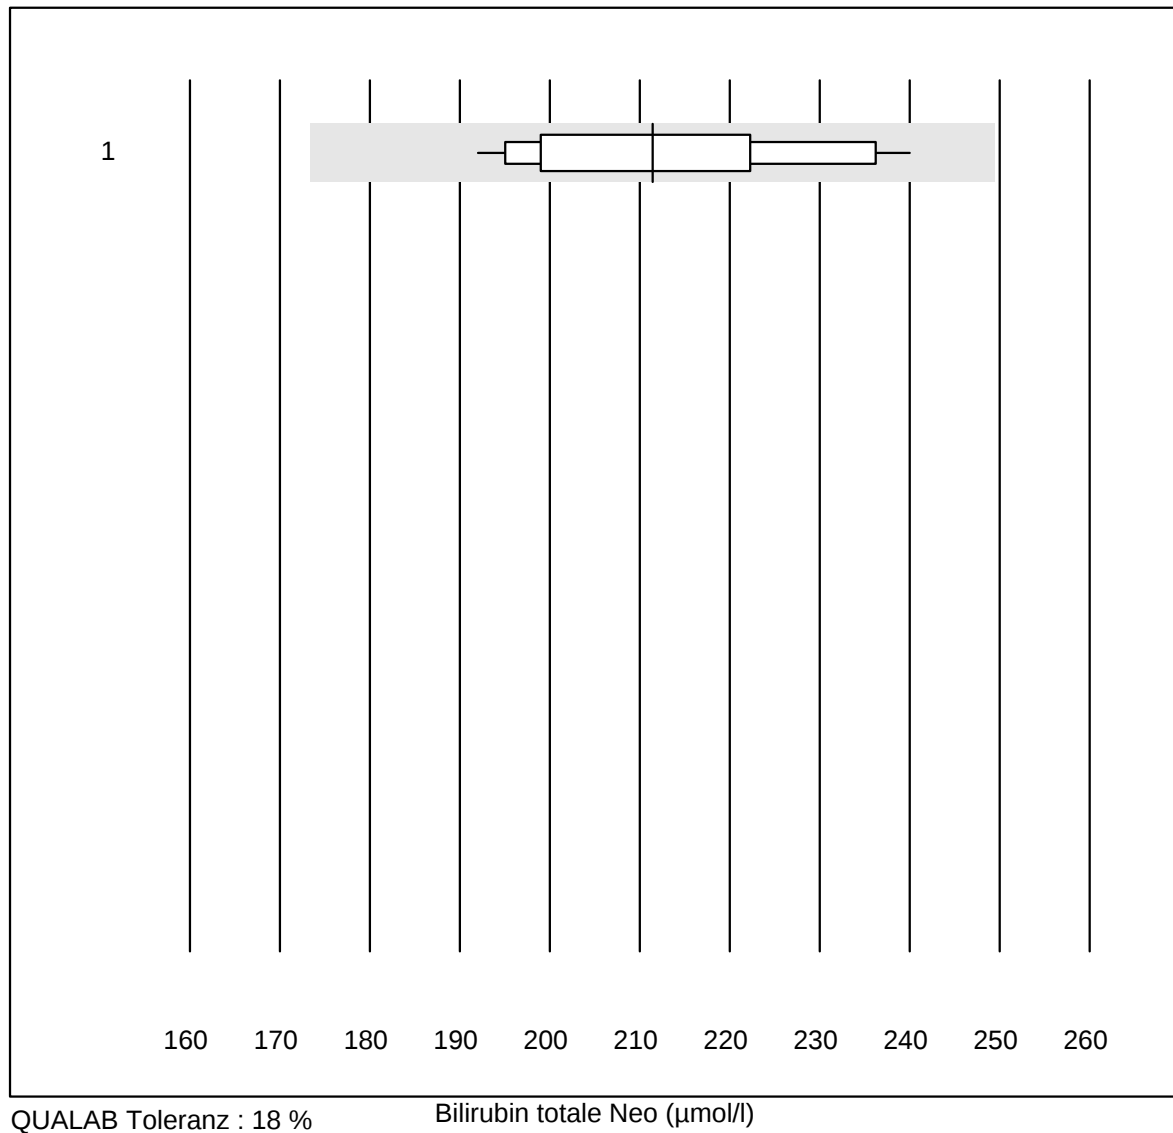


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	17	100.0	0.0	0.0	211	6.7	e

Bilirubin directe

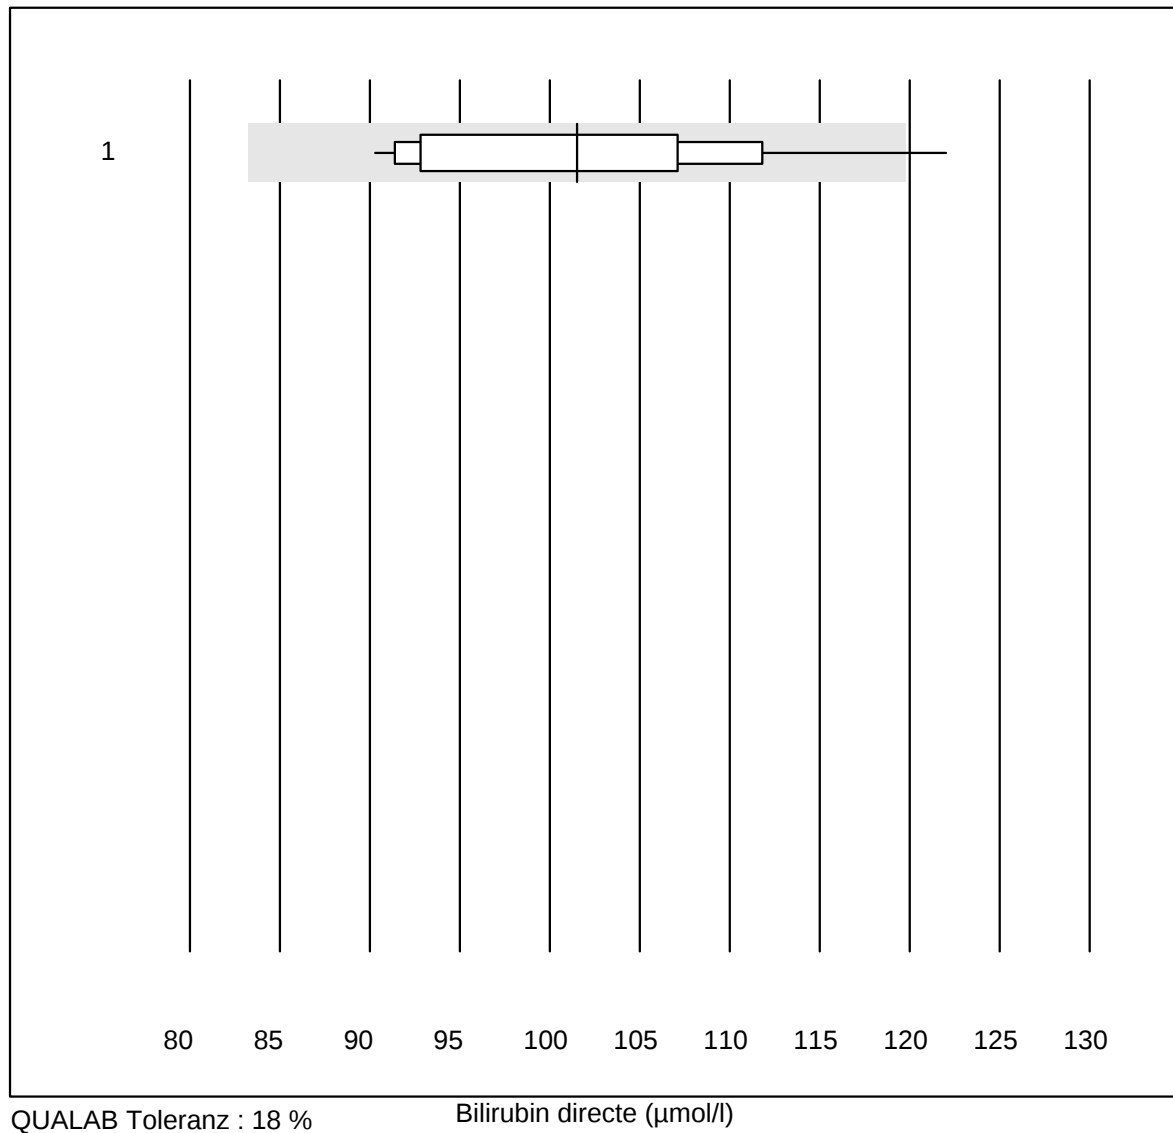

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	16	93.7	6.3	0.0	102	8.5	e

Bilirubin néonatale

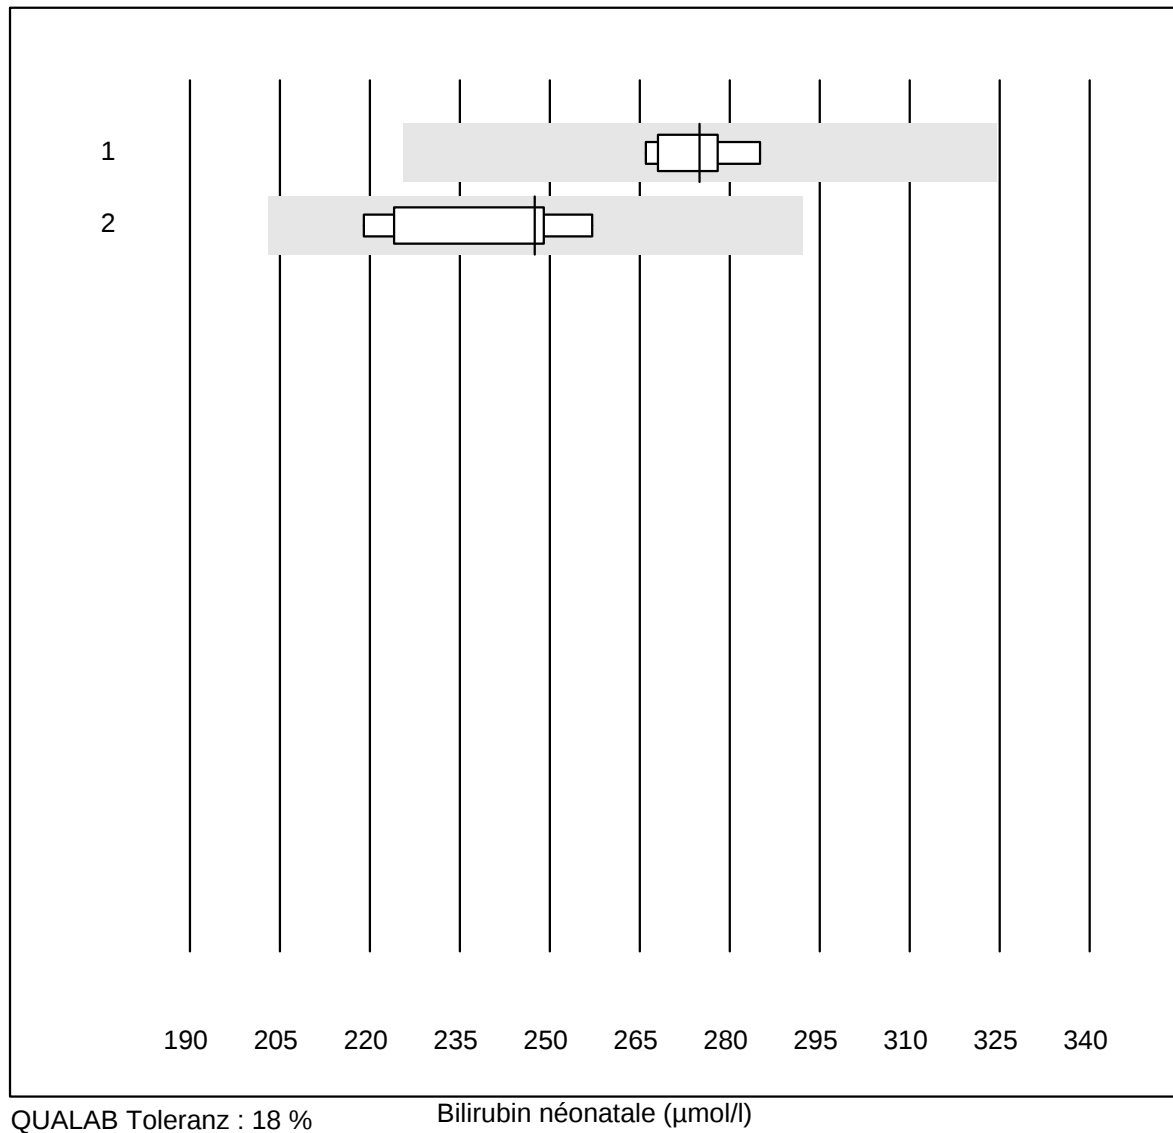


QUALAB Toleranz : 18 %

Bilirubin néonatale (µmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	9	100.0	0.0	0.0	275	2.5	e
2	ABL700/800	8	100.0	0.0	0.0	248	6.1	e

PSA

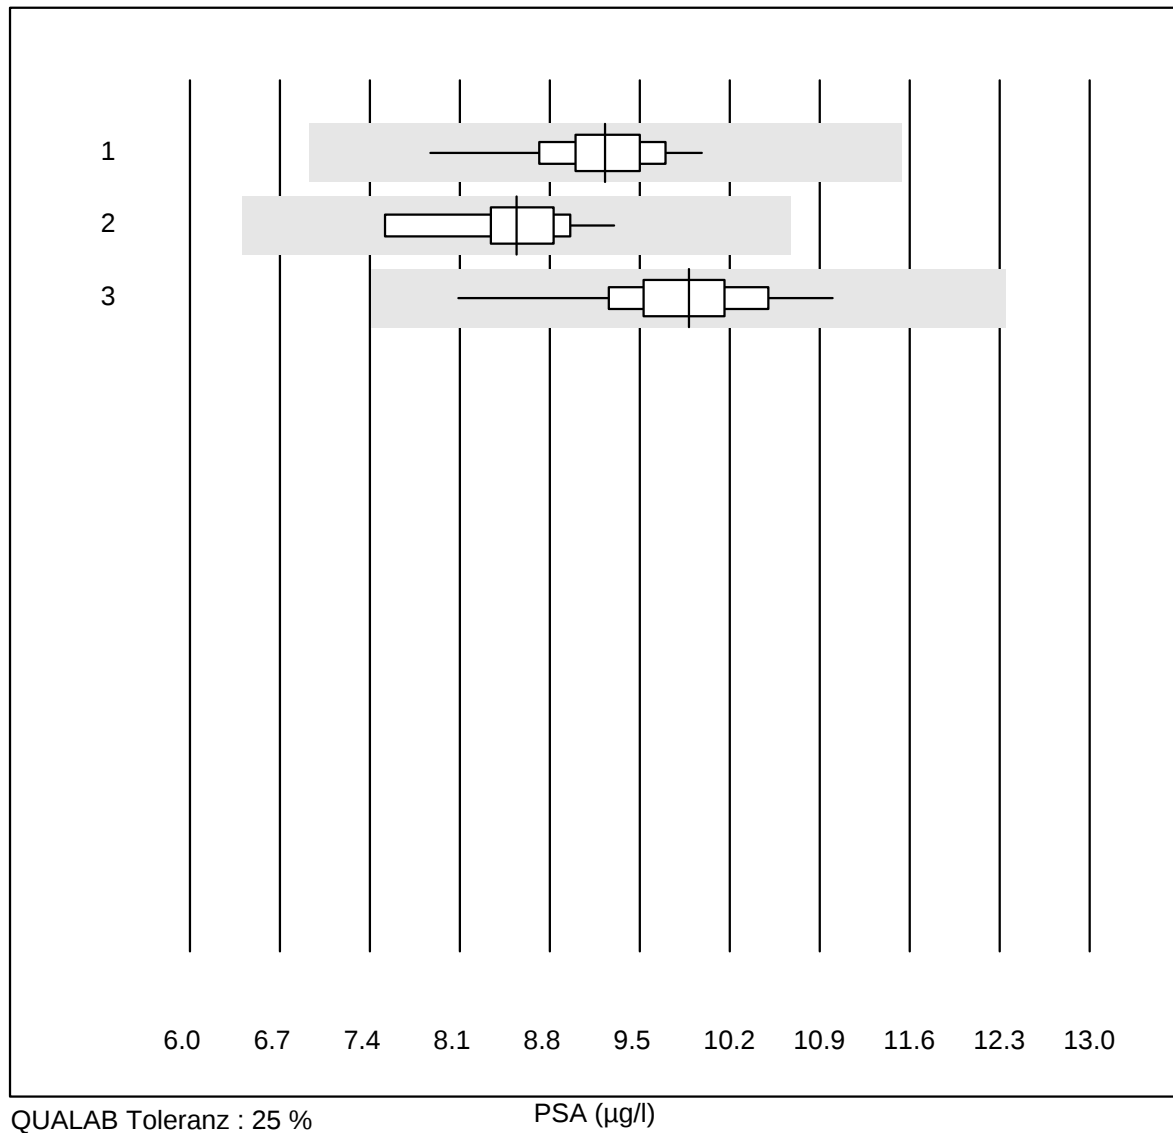

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	13	100.0	0.0	0.0	9.23	5.9	e
2	Architect	10	100.0	0.0	0.0	8.54	5.5	e
3	AFIAS	31	100.0	0.0	0.0	9.88	5.6	e

PSA frei

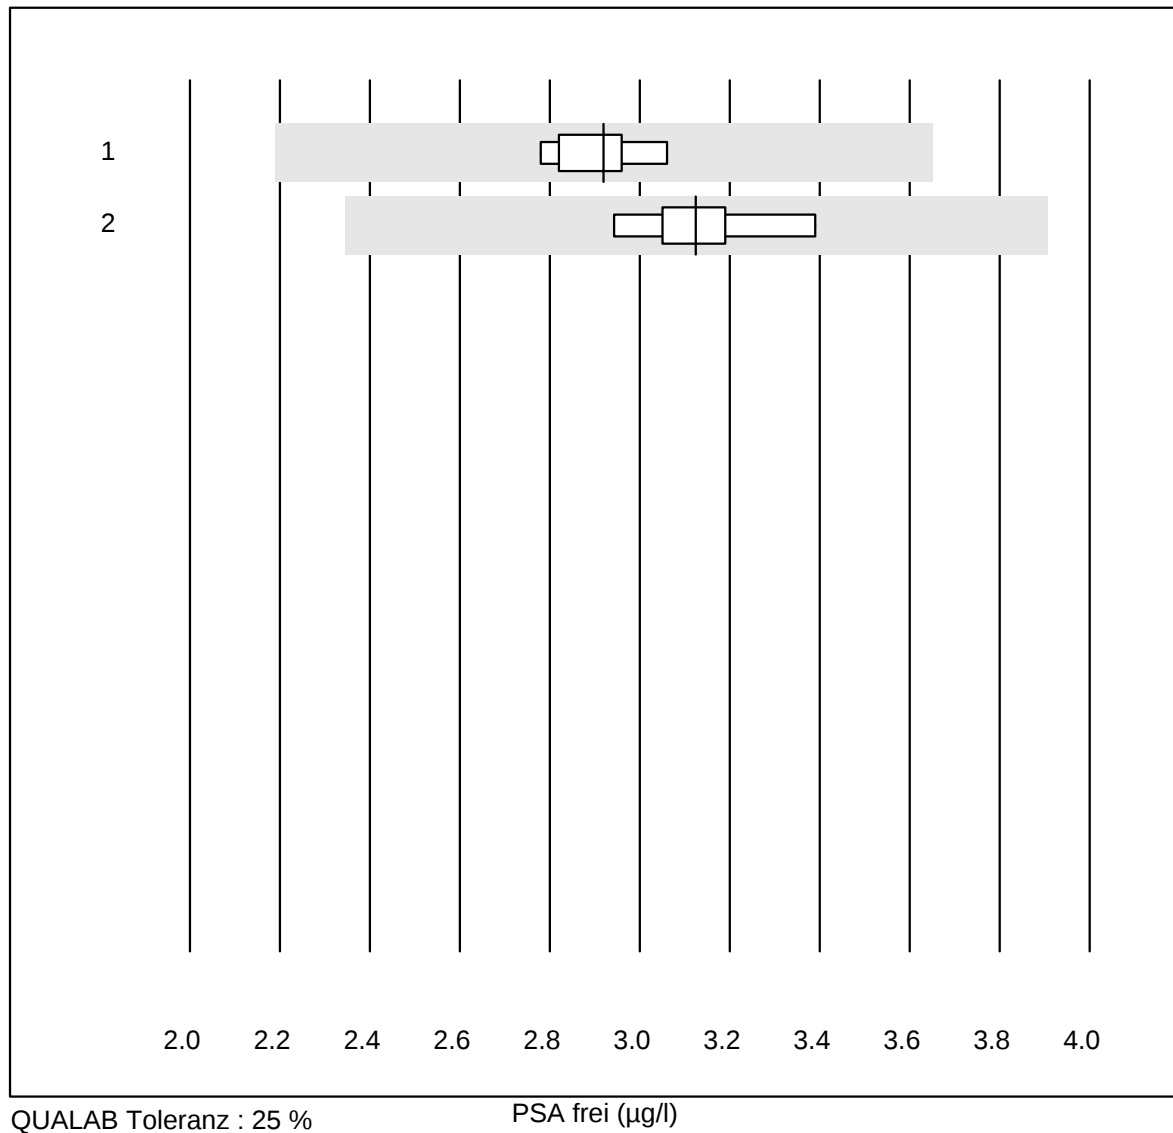


QUALAB Toleranz : 25 %

PSA frei (µg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	7	100.0	0.0	0.0	2.92	3.2	e
2	Architect	8	100.0	0.0	0.0	3.13	4.3	e

CEA

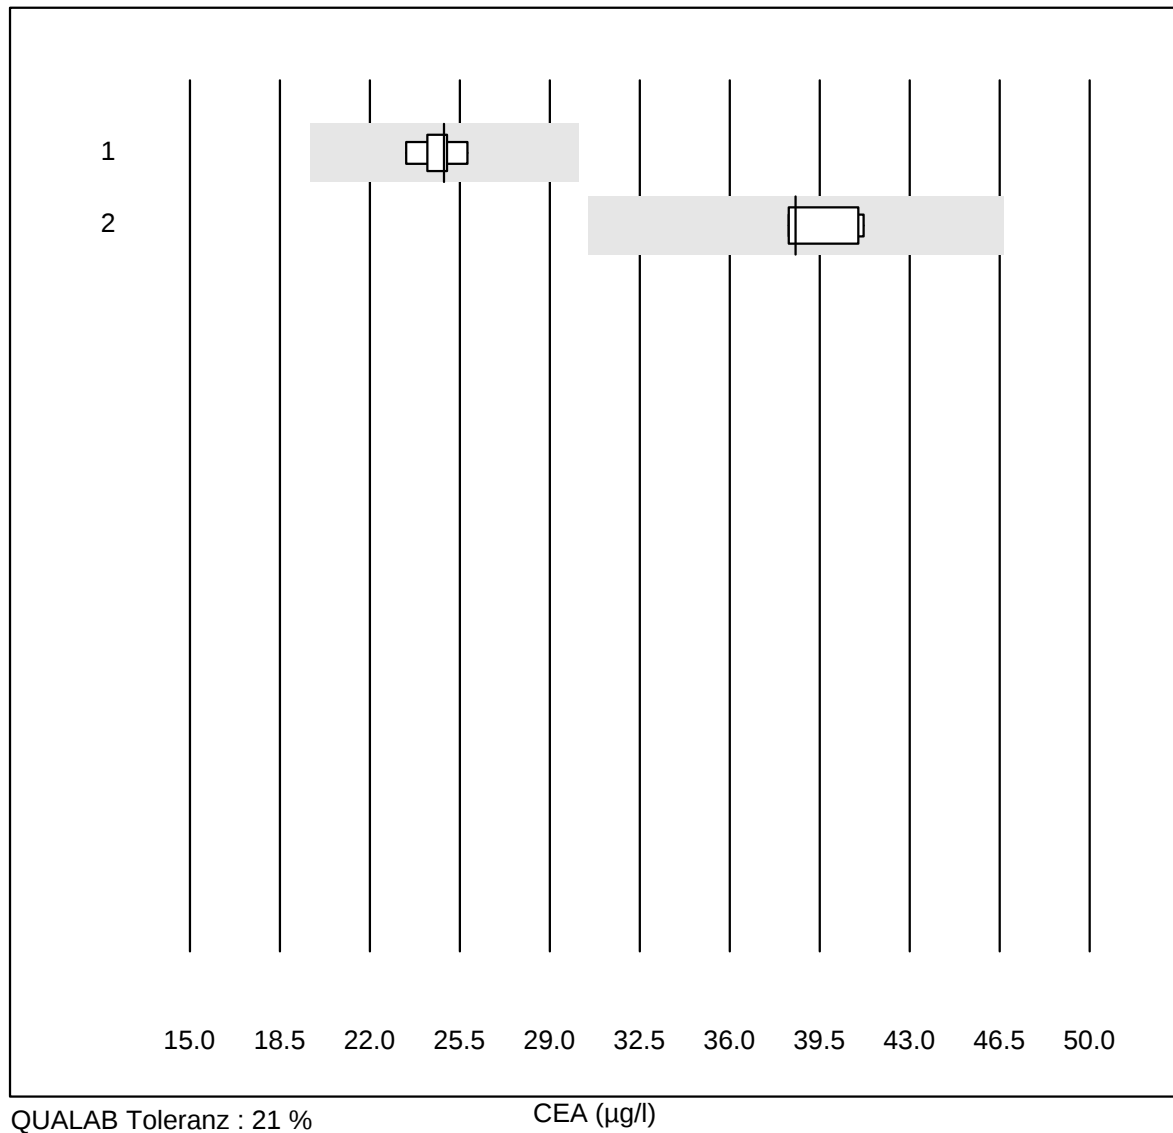


QUALAB Toleranz : 21 %

CEA (µg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	9	100.0	0.0	0.0	24.9	3.1	e
2	Architect	7	85.7	0.0	14.3	38.6	3.5	e


CA 125

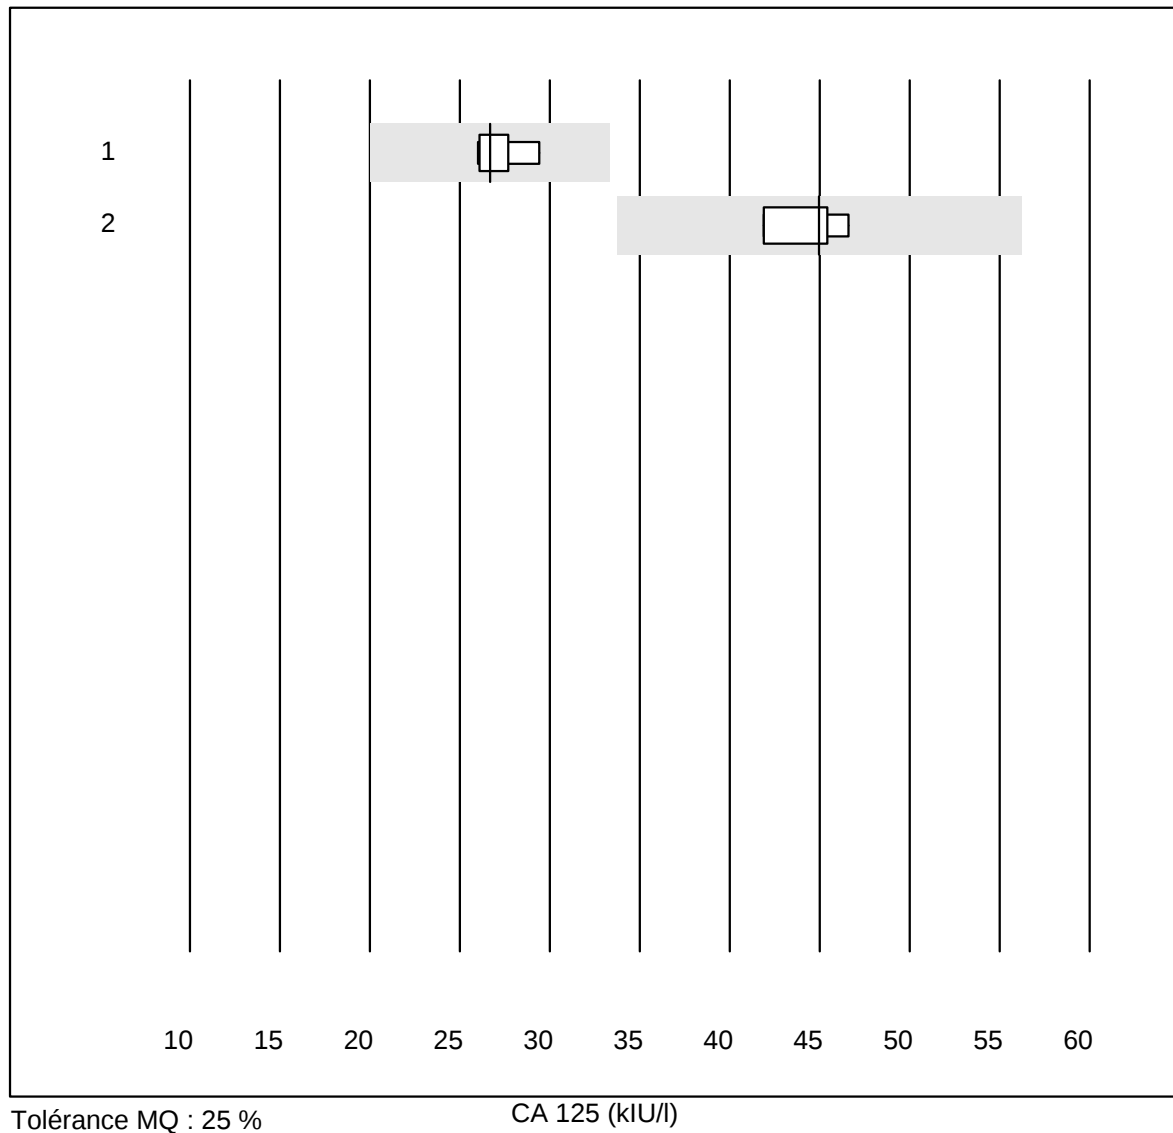


Tolérance MQ : 25 %

CA 125 (kIU/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	5	100.0	0.0	0.0	26.7	5.2	e
2	Architect	4	100.0	0.0	0.0	45.0	4.5	e

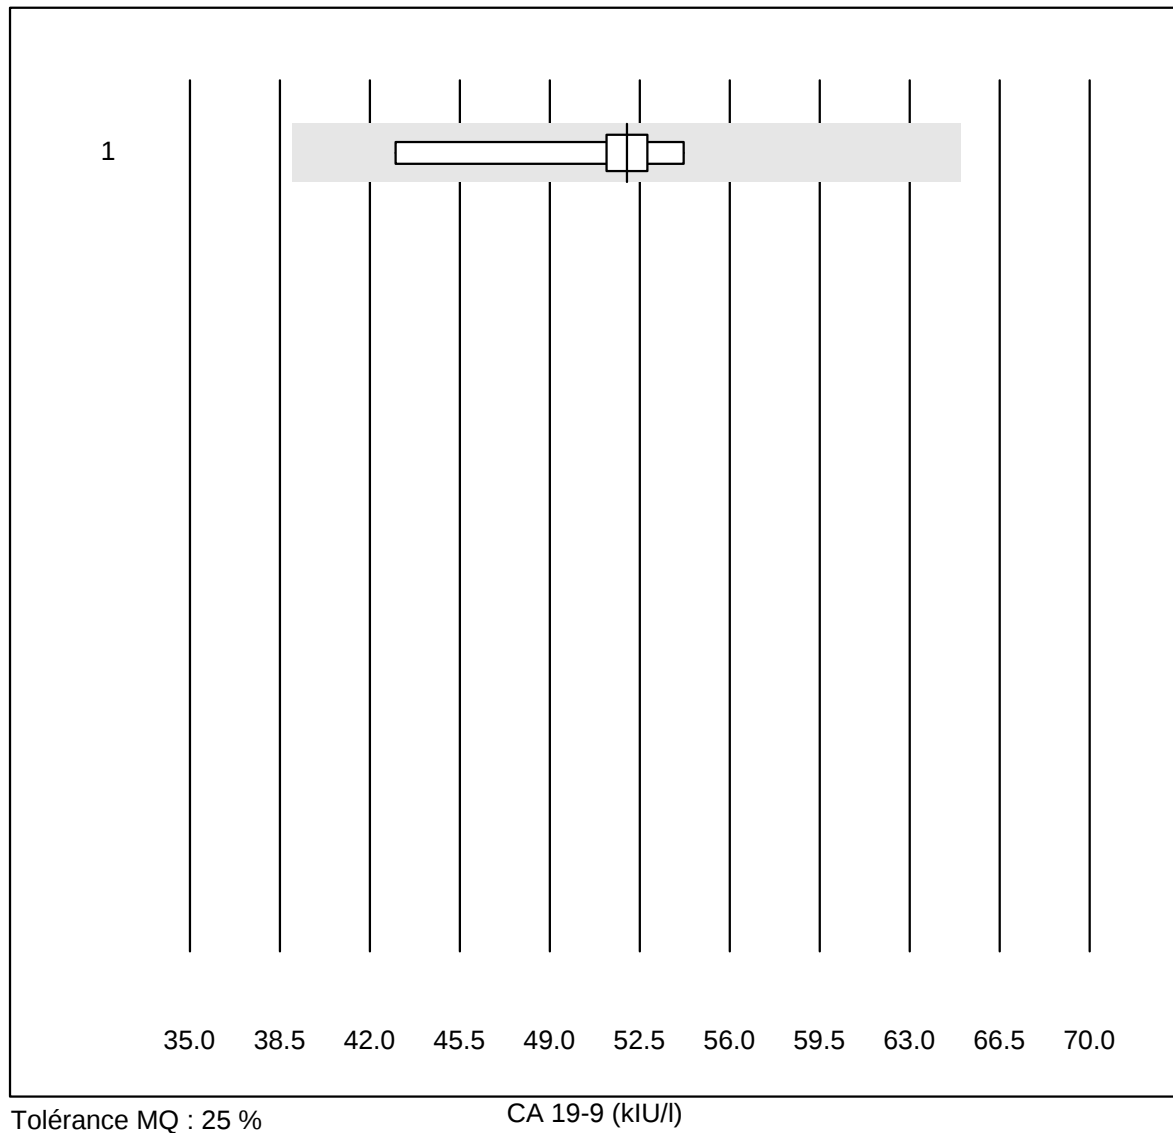CA 19-9


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	5	100.0	0.0	0.0	52.0	8.7	e*

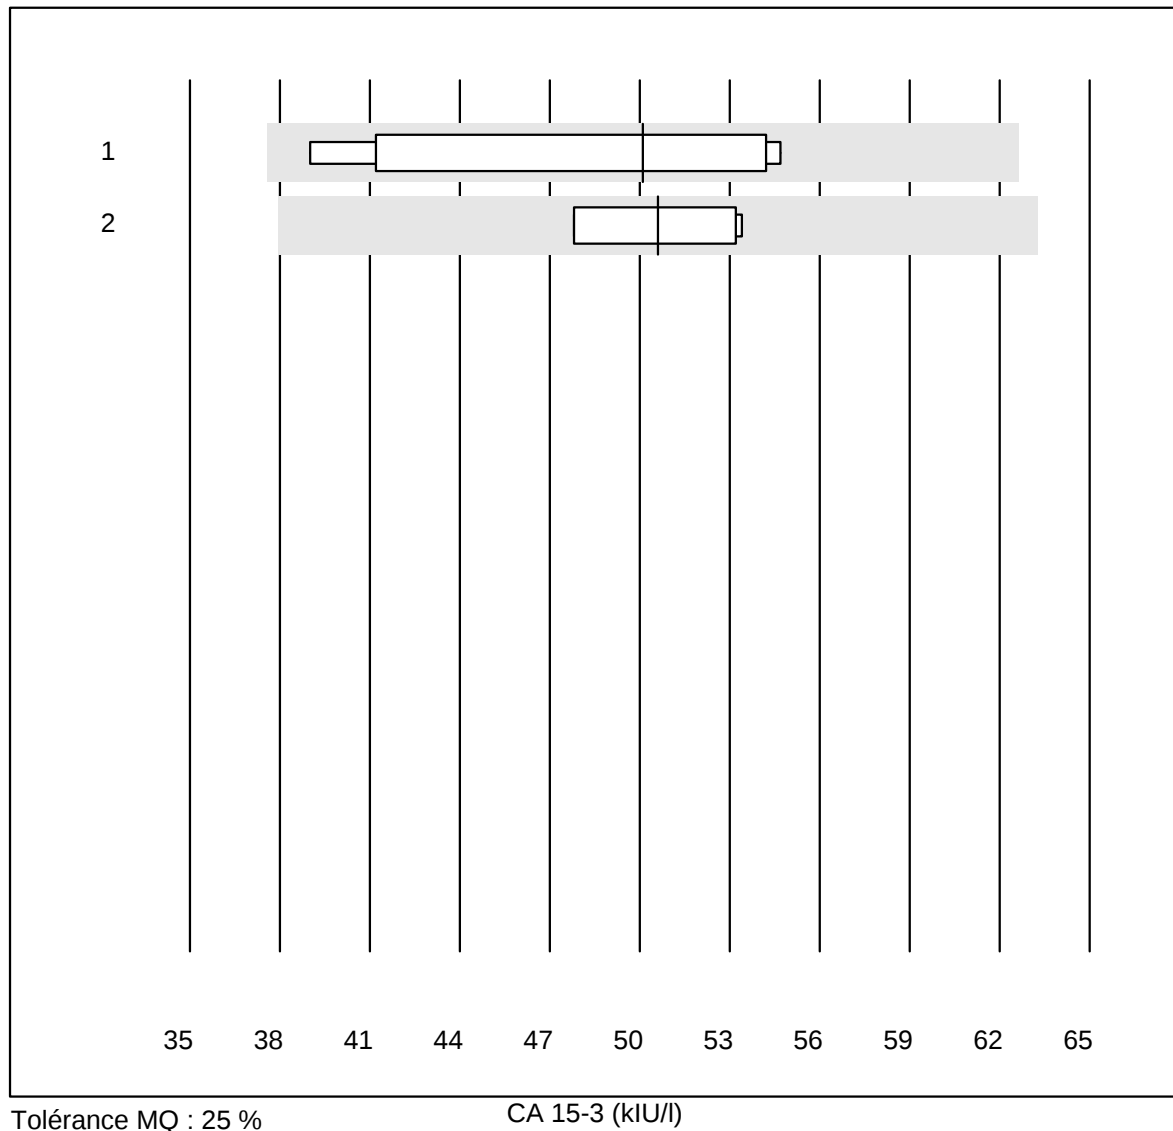CA 15-3

Tolérance MQ : 25 %

CA 15-3 (kIU/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	6	100.0	0.0	0.0	50.1	15.0	a
2	Architect	4	100.0	0.0	0.0	50.6	6.2	e*

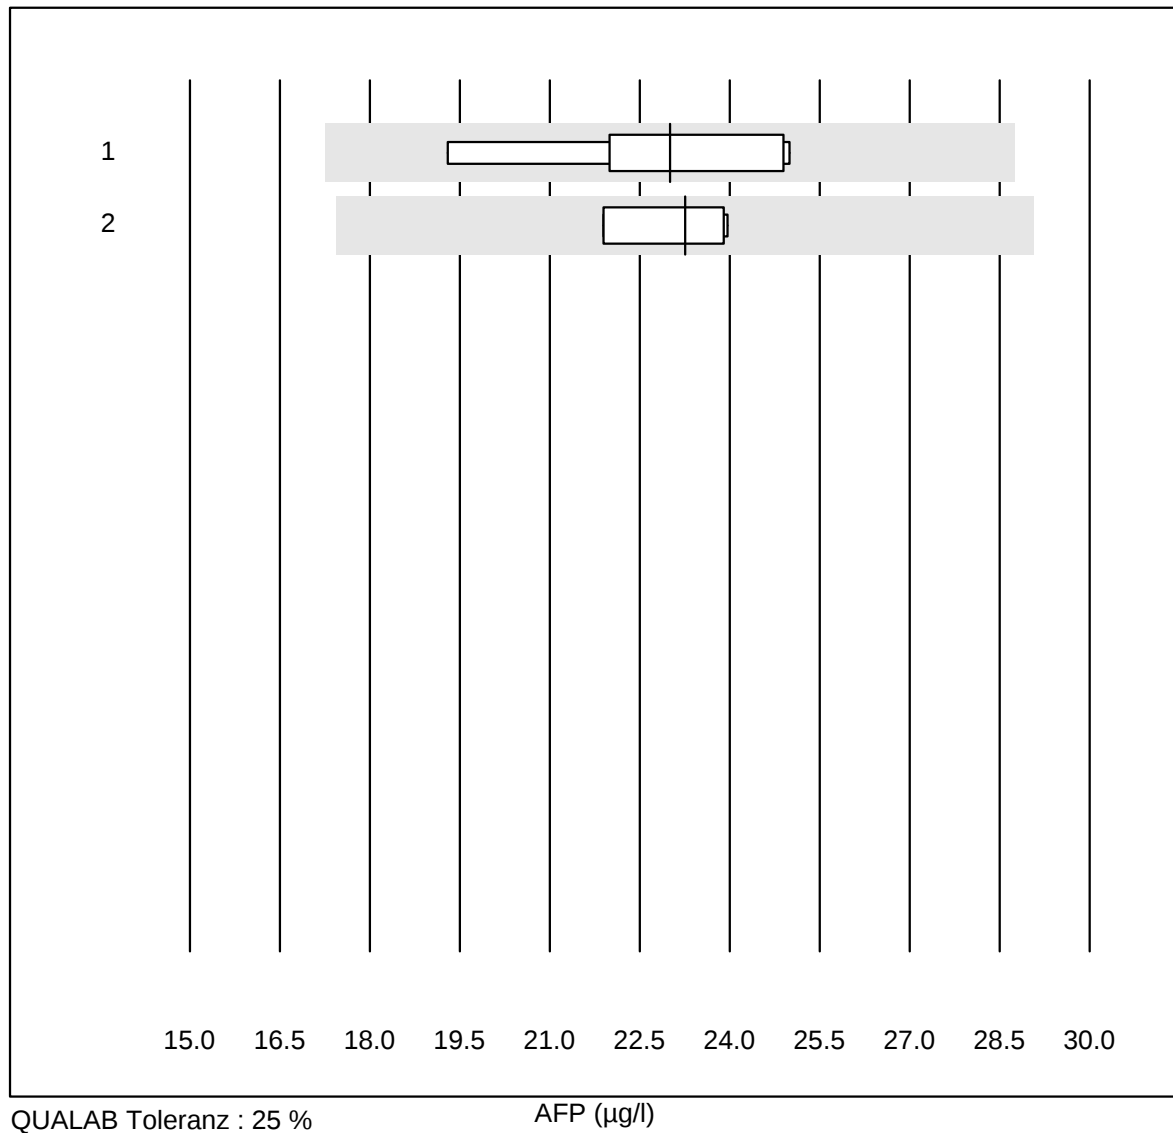
AFP

QUALAB Toleranz : 25 %


AFP (µg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	5	100.0	0.0	0.0	23.0	10.3	e*
2	Architect	4	100.0	0.0	0.0	23.3	4.4	e

HCG qn

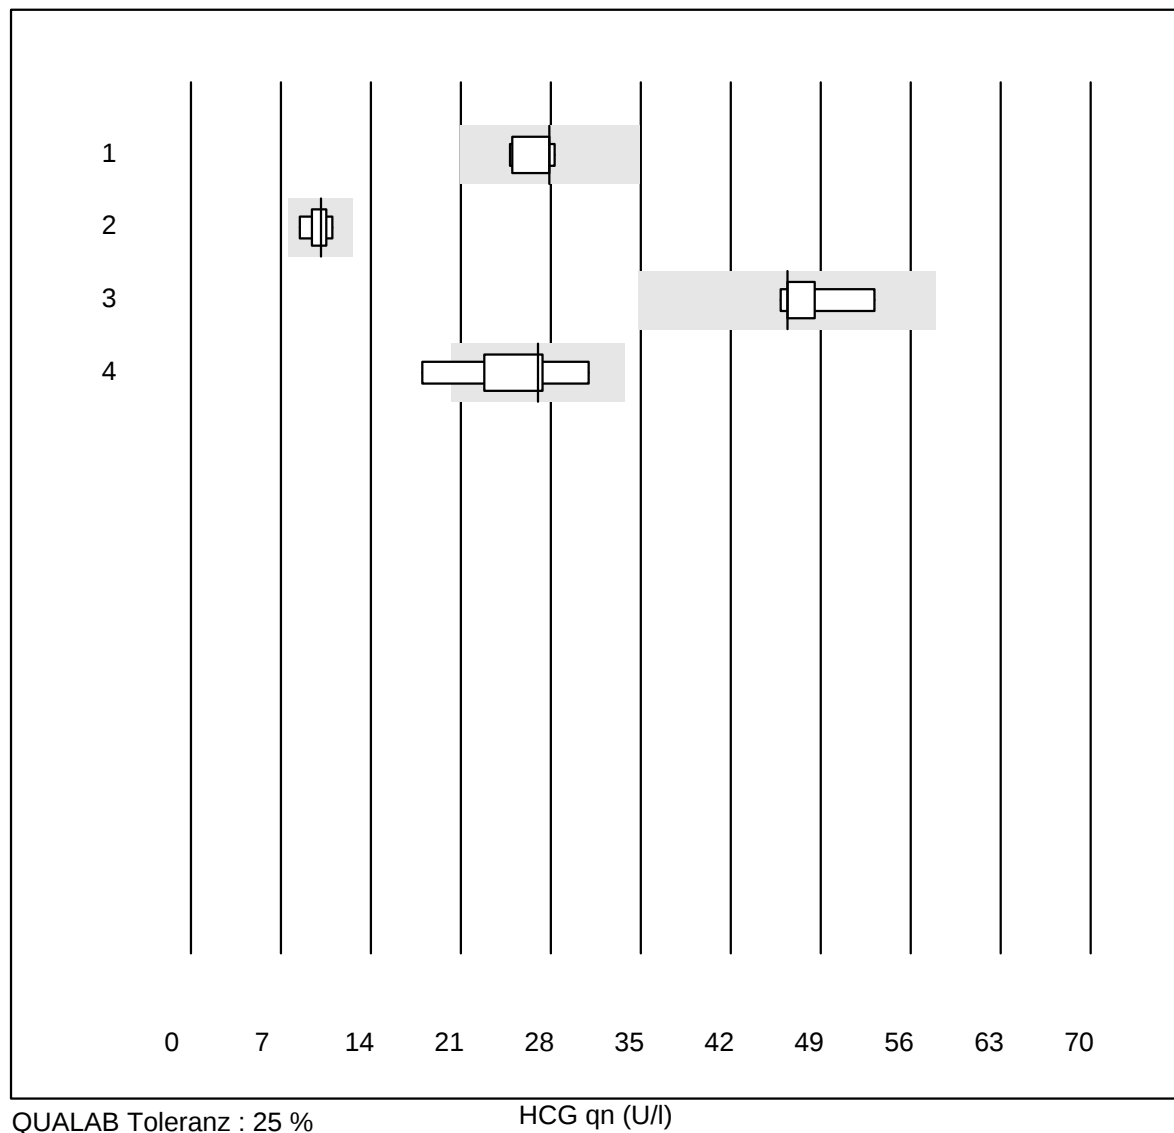


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	8	100.0	0.0	0.0	27.9	5.1	a
2	VIDAS	7	100.0	0.0	0.0	10.1	8.4	e*
3	Architect	8	100.0	0.0	0.0	46.4	4.9	a
4	AFIAS	9	88.9	11.1	0.0	27.0	15.6	e*

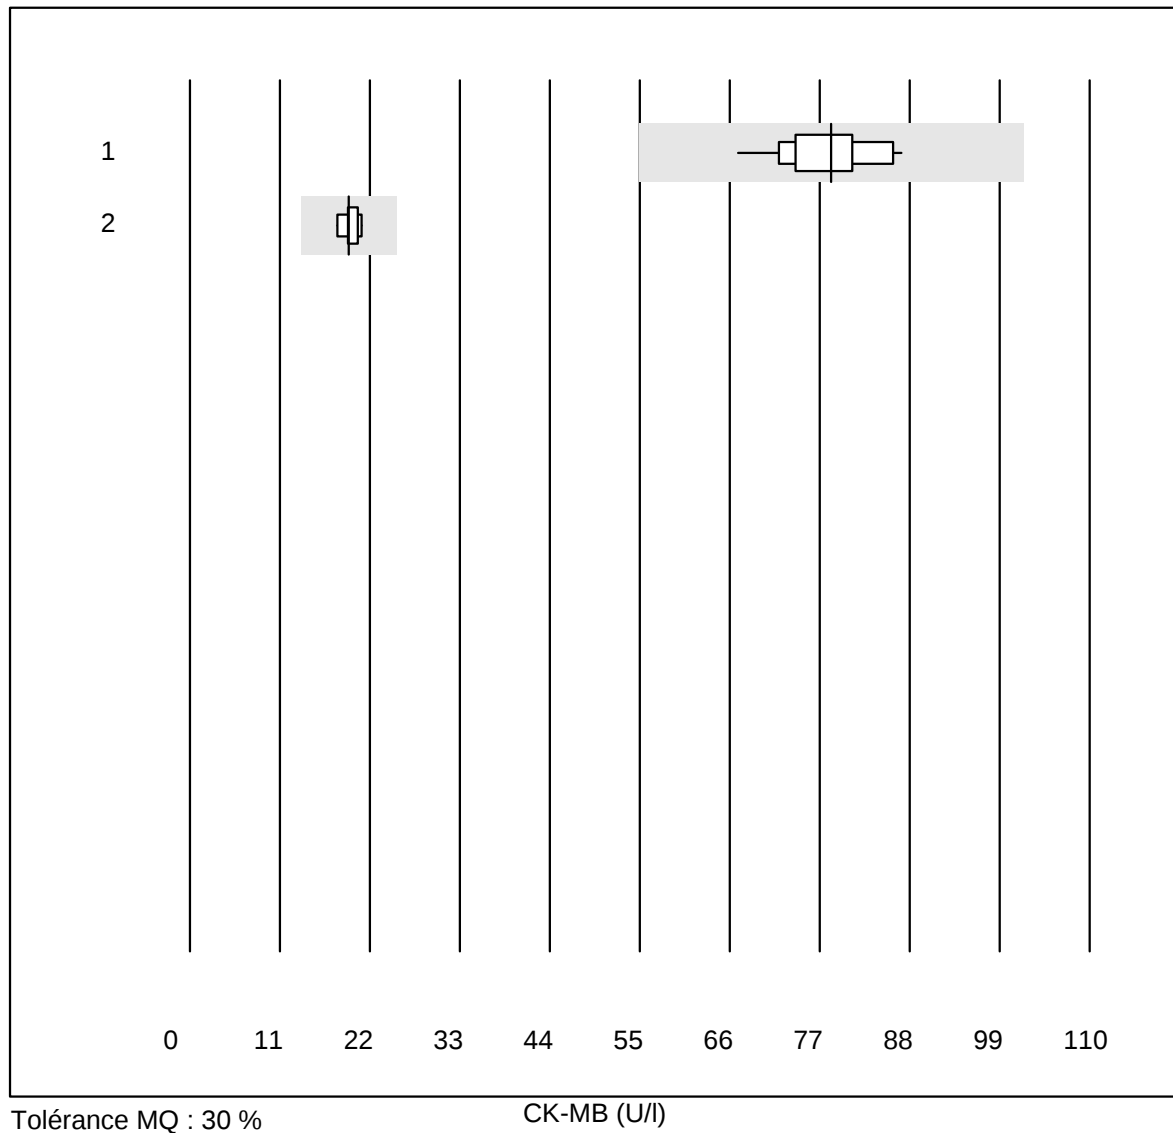CK-MB

Tolérance MQ : 30 %

CK-MB (U/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Fuji Dri-Chem	30	93.3	0.0	6.7	78.4	6.4	e
2	Cobas/Roche	5	100.0	0.0	0.0	19.4	5.9	e

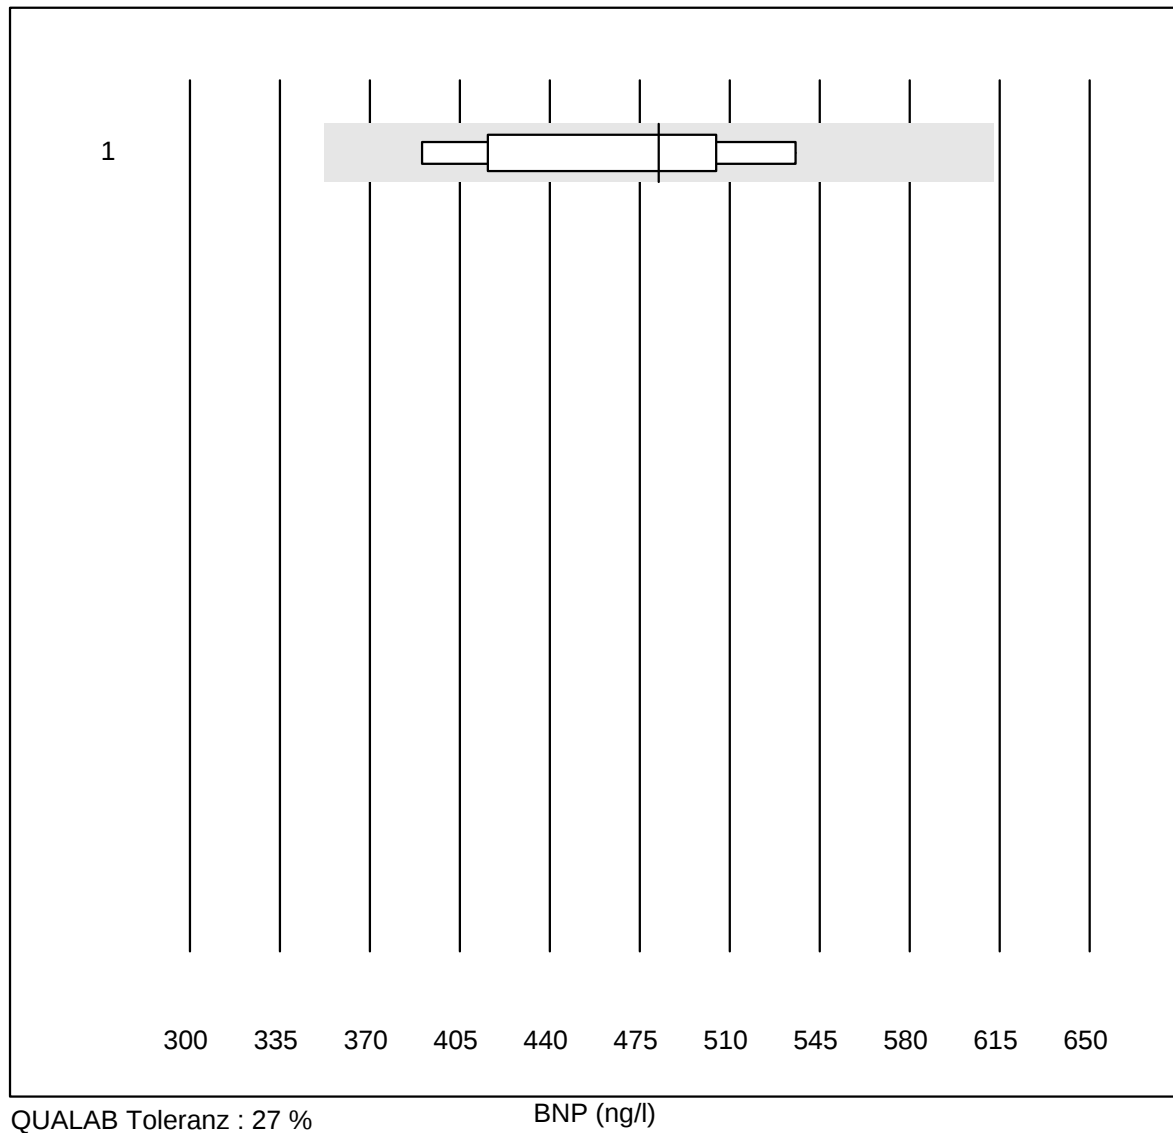
BNP

QUALAB Toleranz : 27 %

BNP (ng/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Architect	6	100.0	0.0	0.0	482.3	12.0	e*

Cholestérol PTS

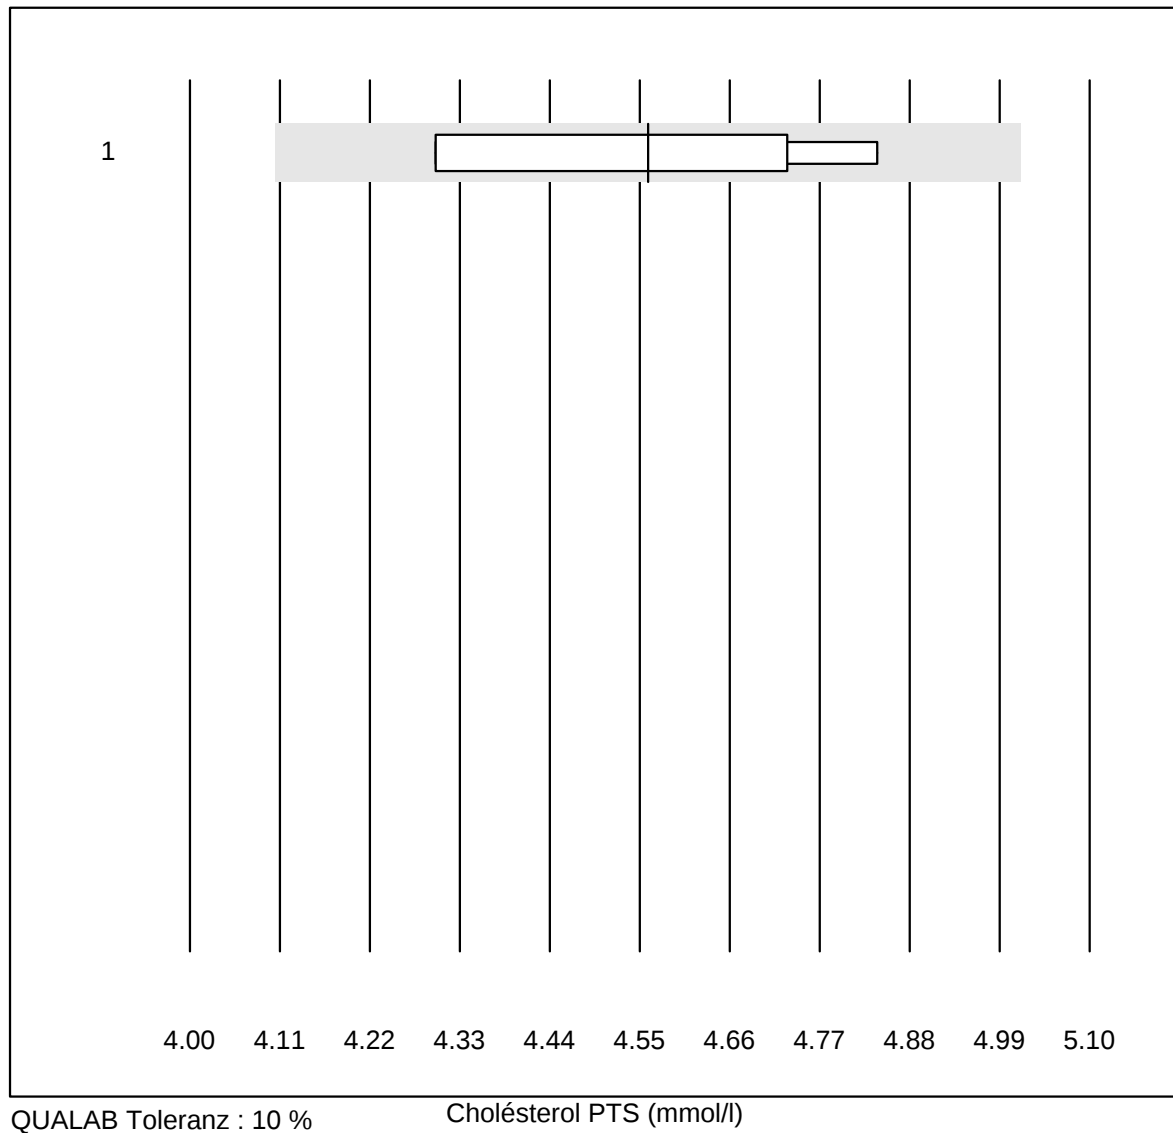

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	CardioChek	10	80.0	0.0	20.0	4.56	4.5	e*

Chol sterol HDL PTS

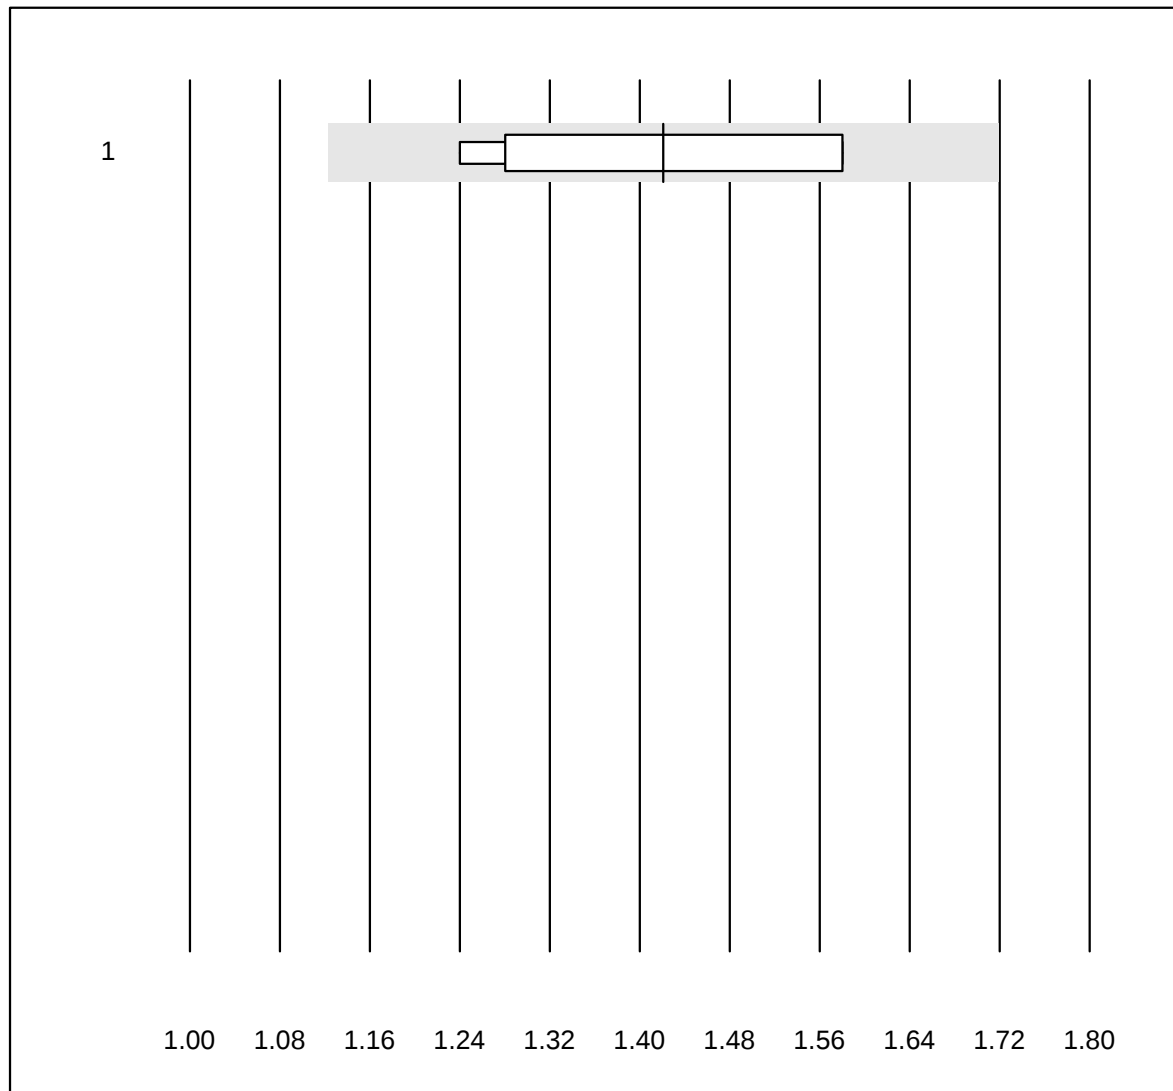


QUALAB Toleranz : 21 %

Chol sterol HDL PTS (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erf�llt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	CardioChek	10	90.0	0.0	10.0	1.42	10.9	e*


Triglyc rides PTS

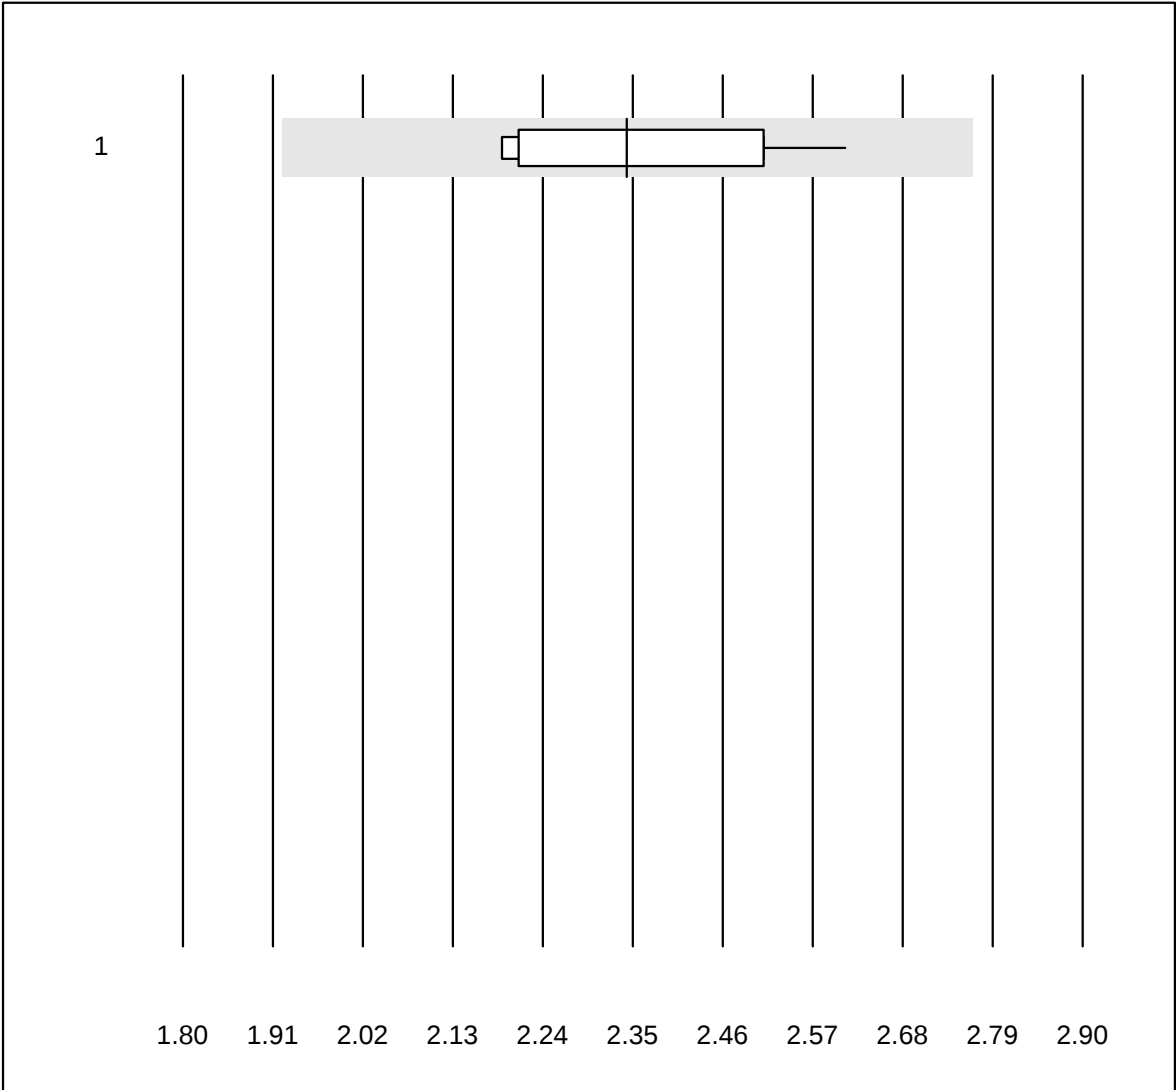

QUALAB Toleranz : 18 % Triglyc rides PTS (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erf�llt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	CardioChek	10	100.0	0.0	0.0	2.34	6.5	e

C-Peptid

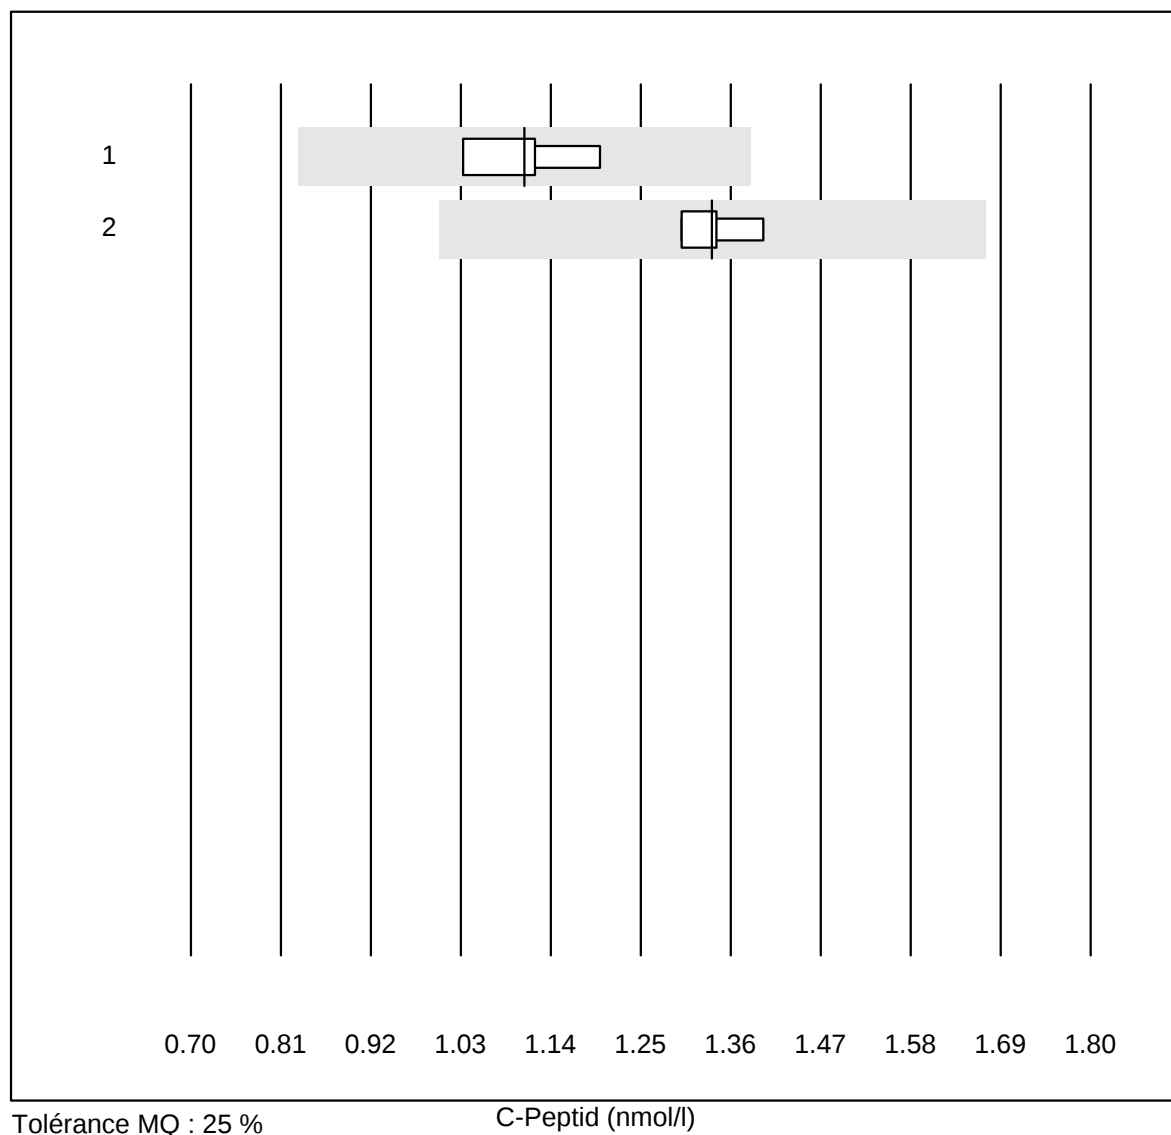


Tolérance MQ : 25 %

C-Peptid (nmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	1.11	6.2	e*
2	Liaison	4	100.0	0.0	0.0	1.34	3.1	e

Procalcitonine

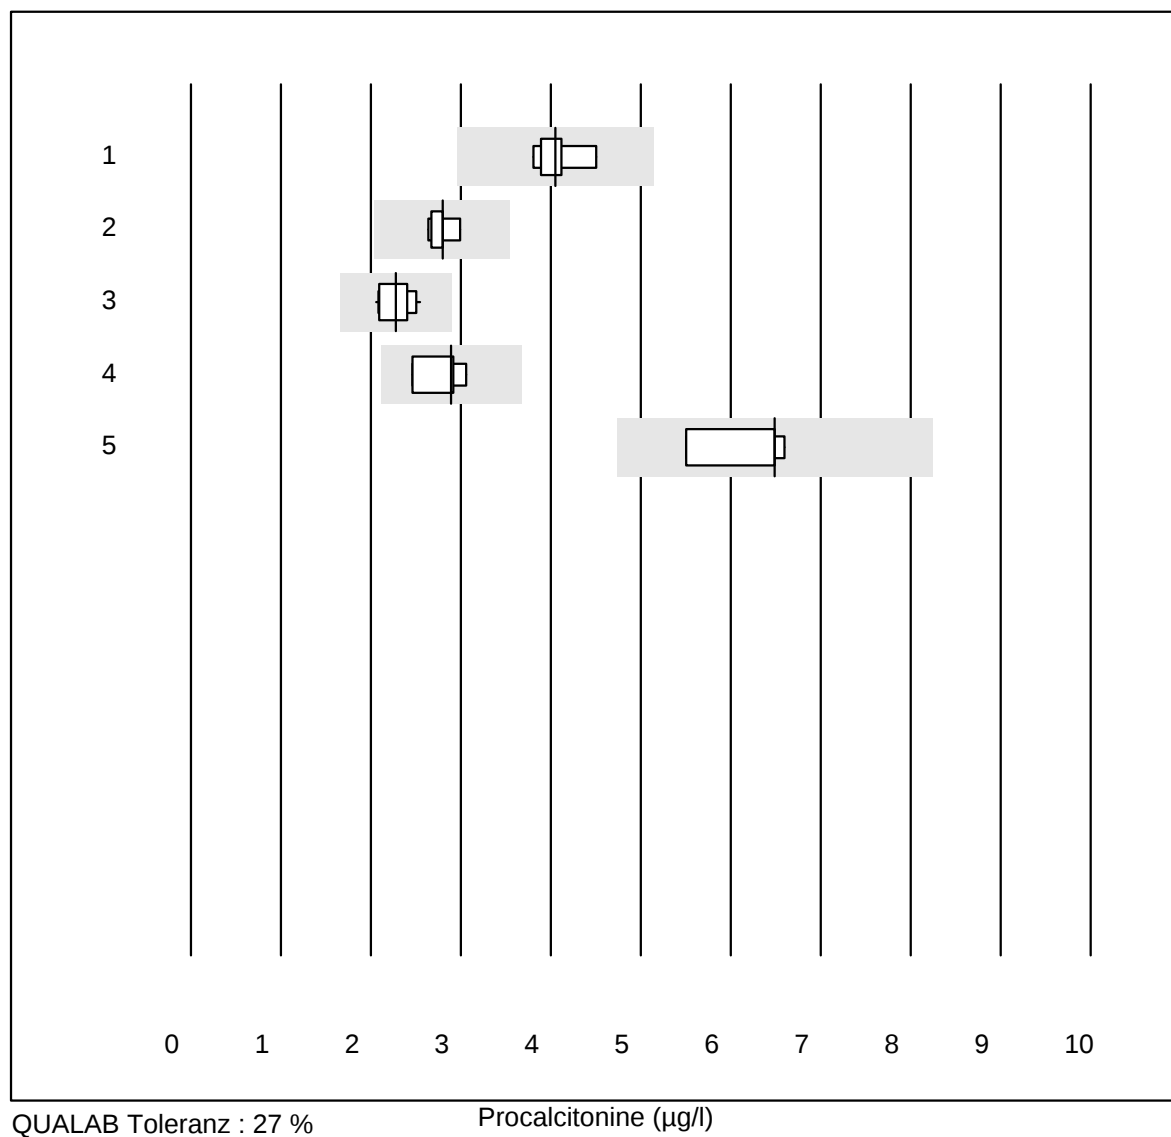


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Architect	6	100.0	0.0	0.0	4.05	5.9	e
2	Cobas	8	100.0	0.0	0.0	2.80	4.4	e
3	VIDAS	12	100.0	0.0	0.0	2.28	7.8	e
4	ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	2.89	9.1	e*
5	Autres méthodes	5	80.0	0.0	20.0	6.49	8.0	e*

EPO

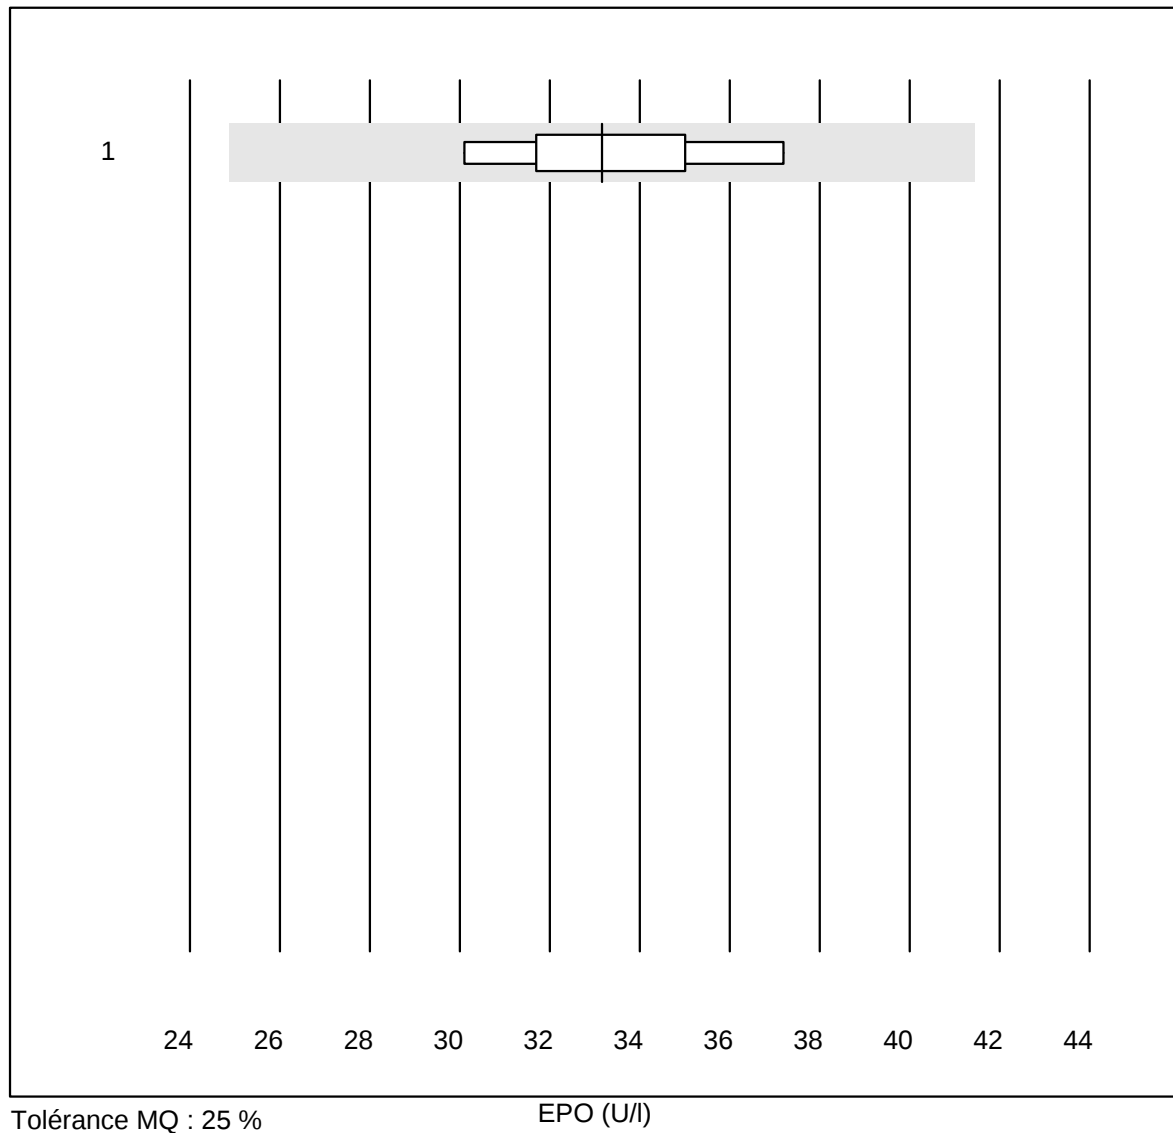

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Immulite	5	100.0	0.0	0.0	33.2	8.7	a

Parathormone

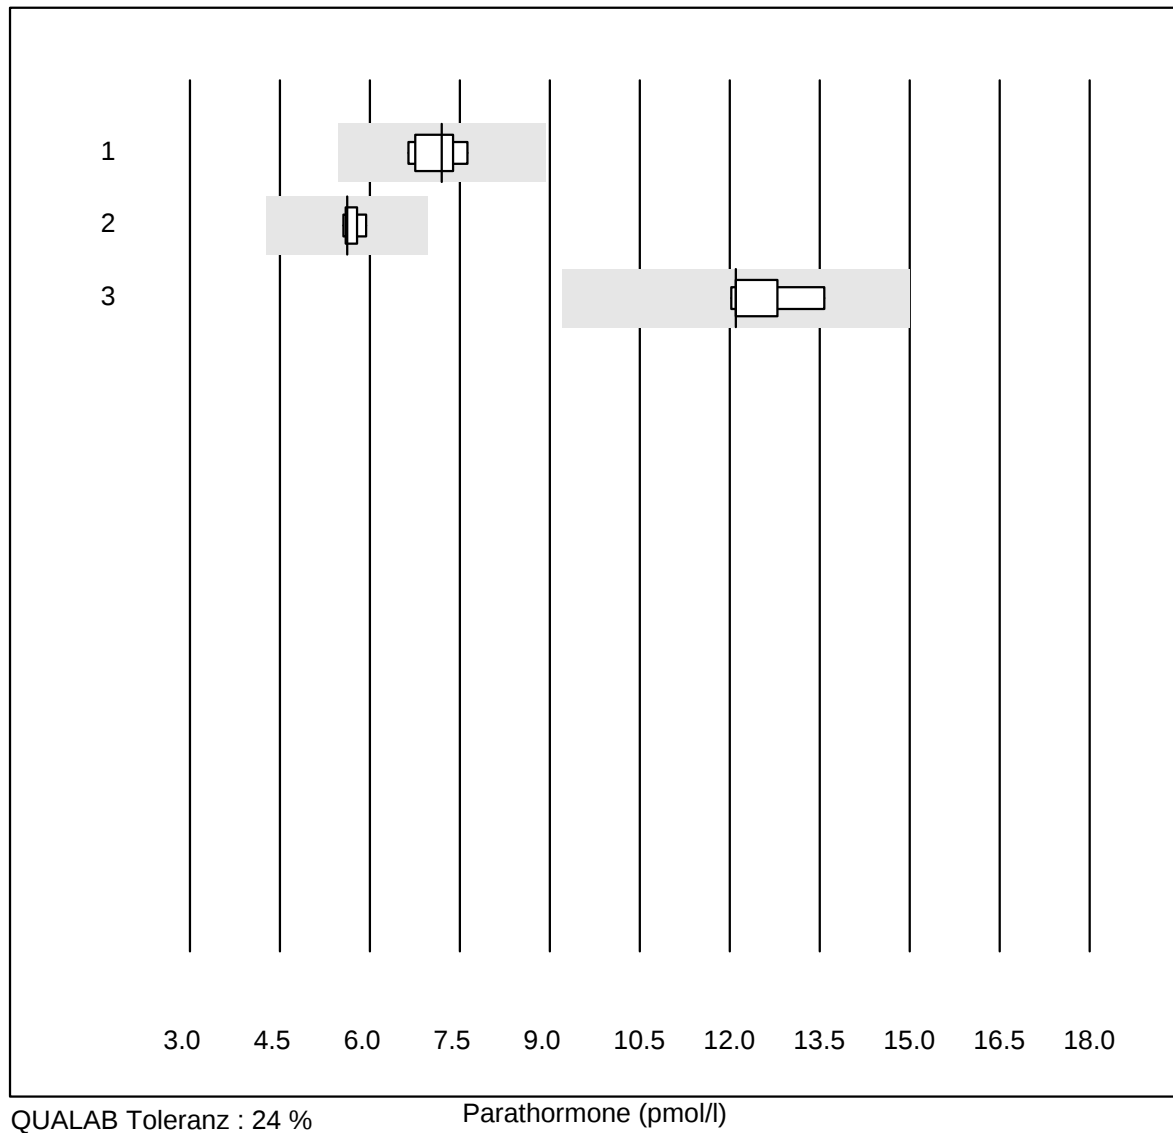


QUALAB Toleranz : 24 %

Parathormone (pmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas PTH STAT	7	100.0	0.0	0.0	7.2	4.9	e
2	Cobas	7	100.0	0.0	0.0	5.6	2.4	e
3	Architect	5	100.0	0.0	0.0	12.1	5.4	e

Osmolalität

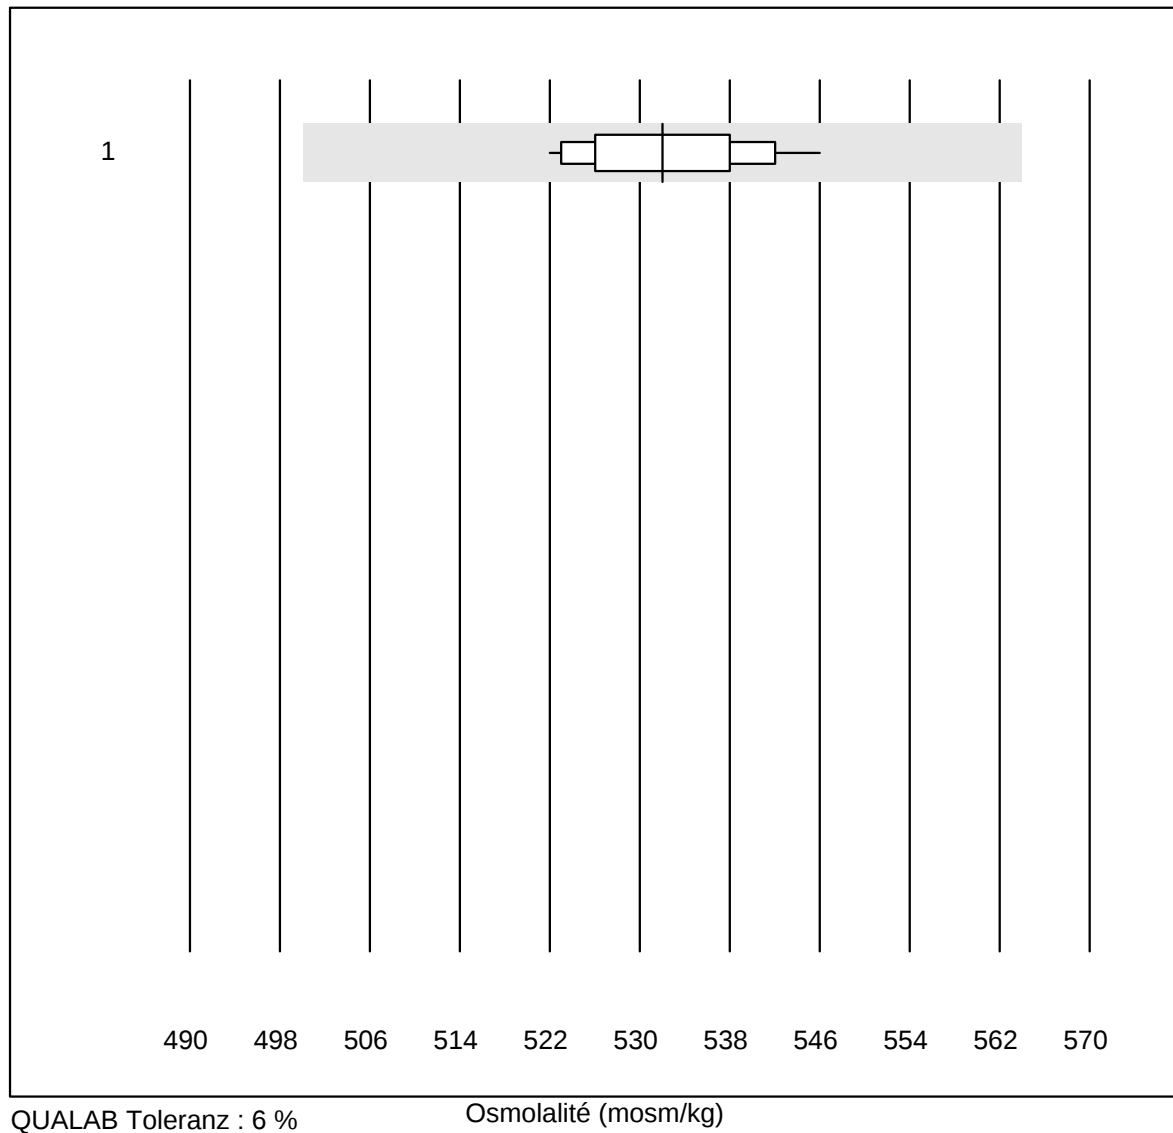


QUALAB Toleranz : 6 %

Osmolalität (mosm/kg)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cryoscopie	16	100.0	0.0	0.0	532	1.3	e

Kalium-K22

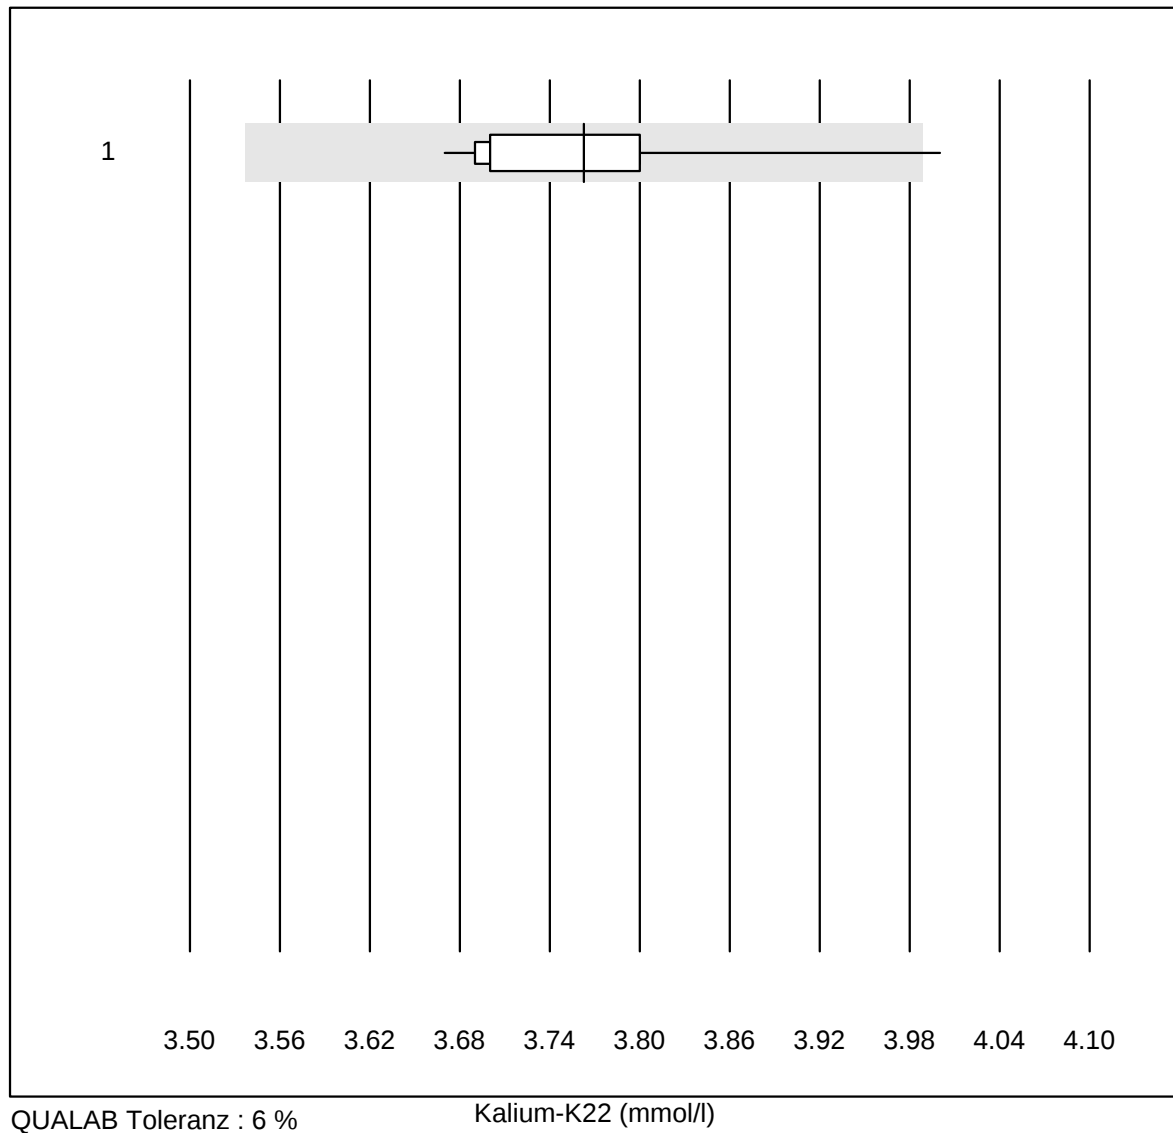


QUALAB Toleranz : 6 %

Kalium-K22 (mmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ISE	11	90.9	9.1	0.0	3.8	2.5	e*

Natrium-K22

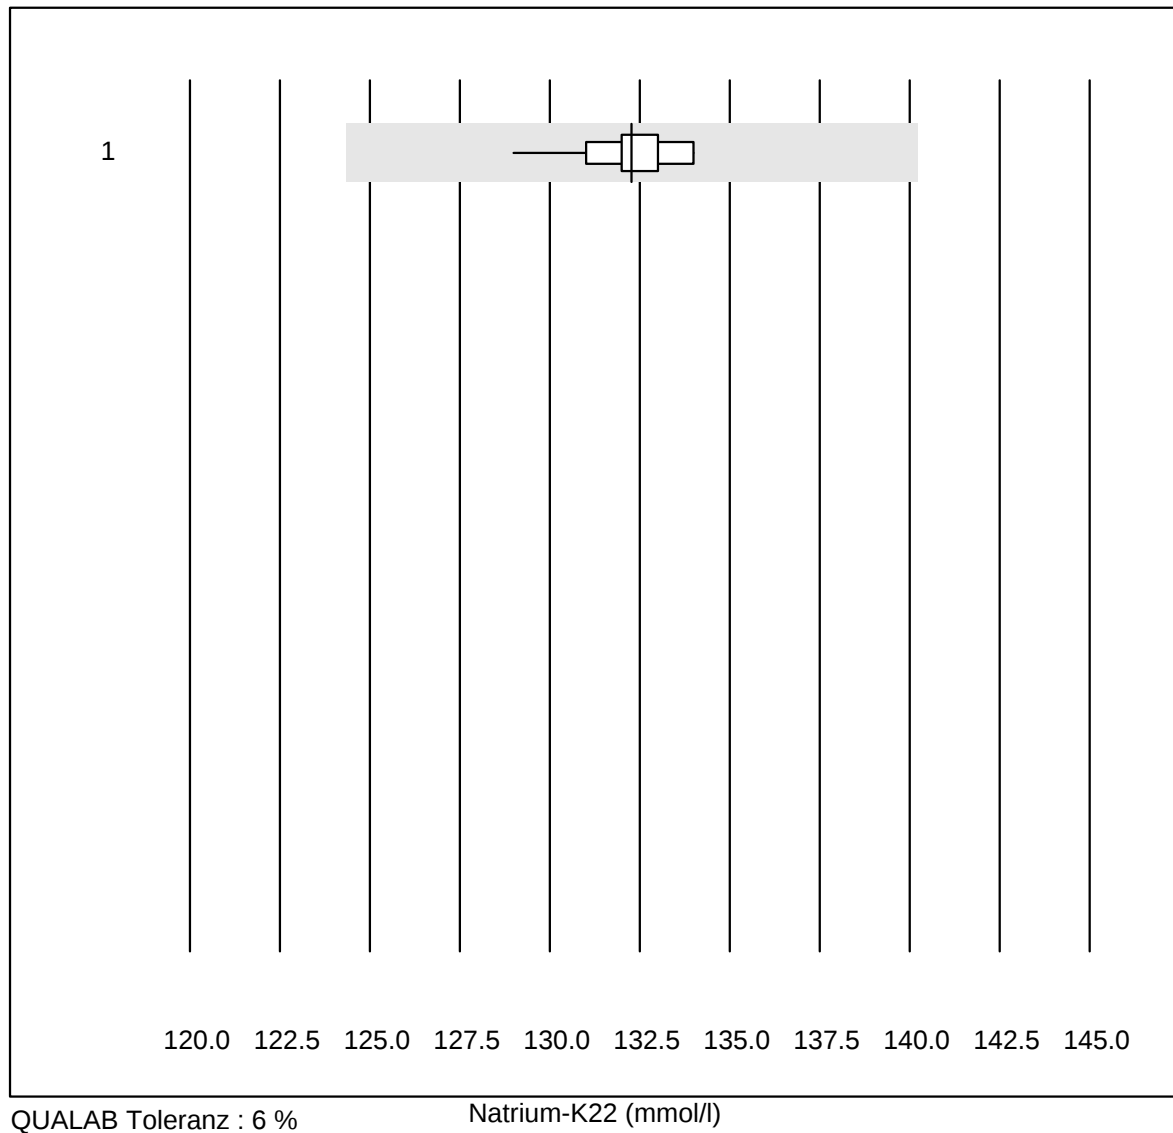


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ISE	11	100.0	0.0	0.0	132	1.1	e

Glukose-K22

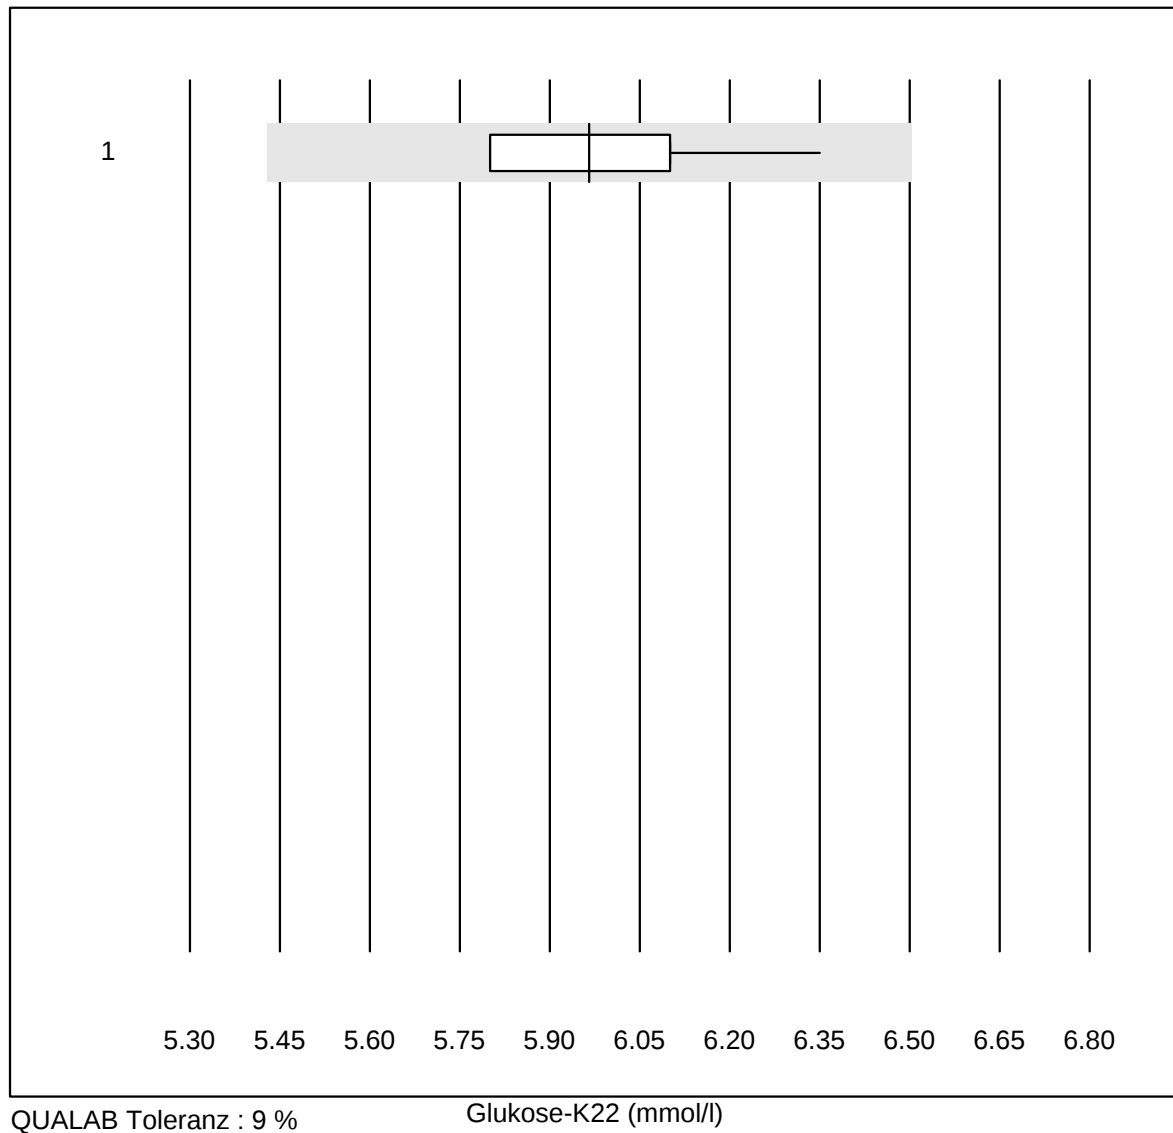


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	11	100.0	0.0	0.0	6.0	2.8	e

Harnstoff-K22

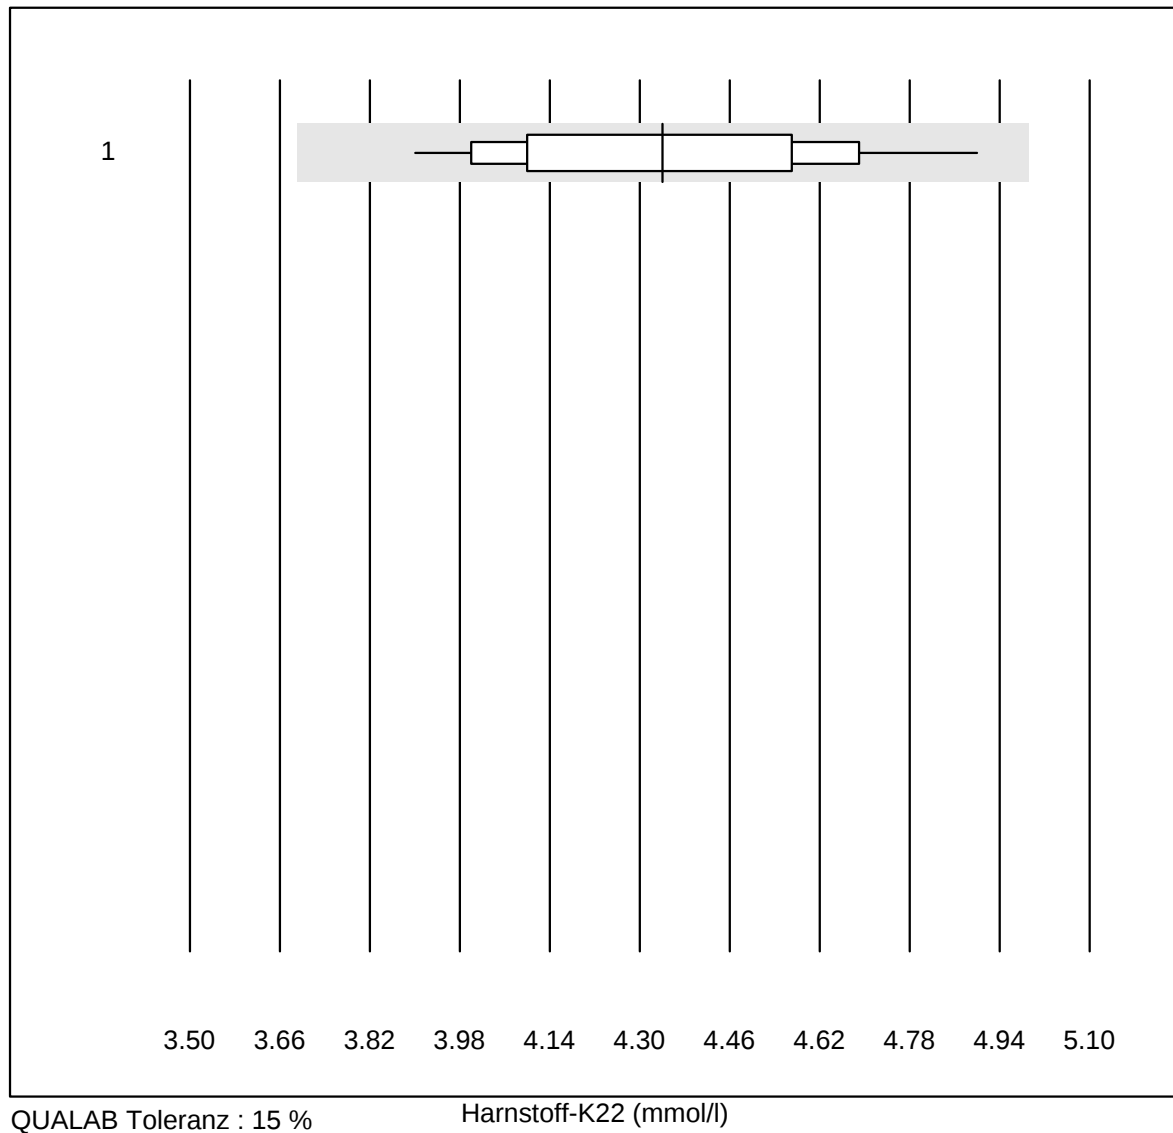


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	11	100.0	0.0	0.0	4.3	6.8	e*

Osmotische Lücke

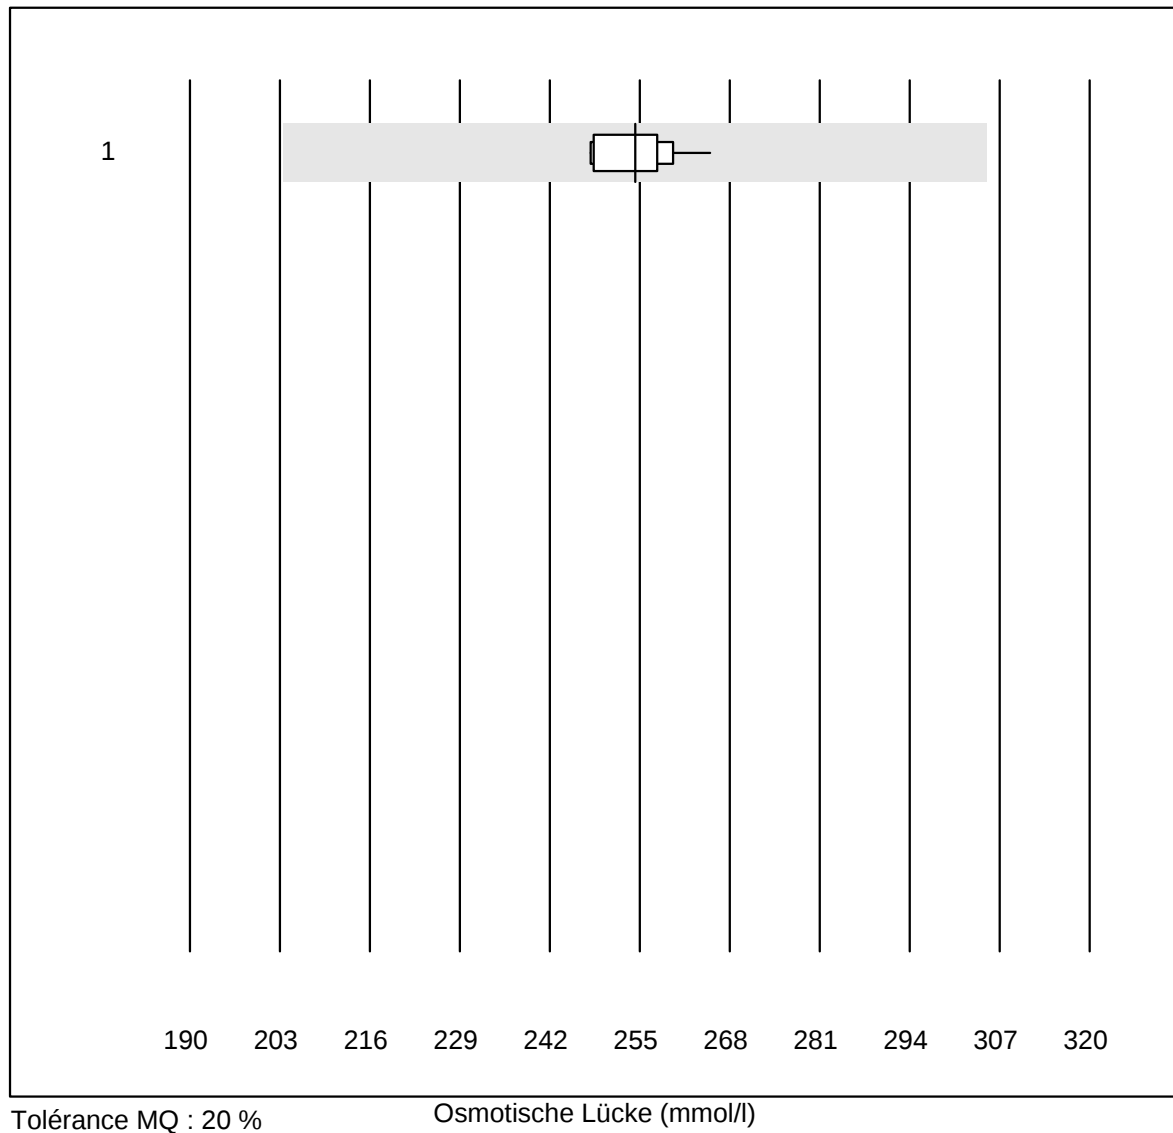


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Formel 1 (2Na+K+Glu+	10	100.0	0.0	0.0	254.3	2.3	e

Digoxin

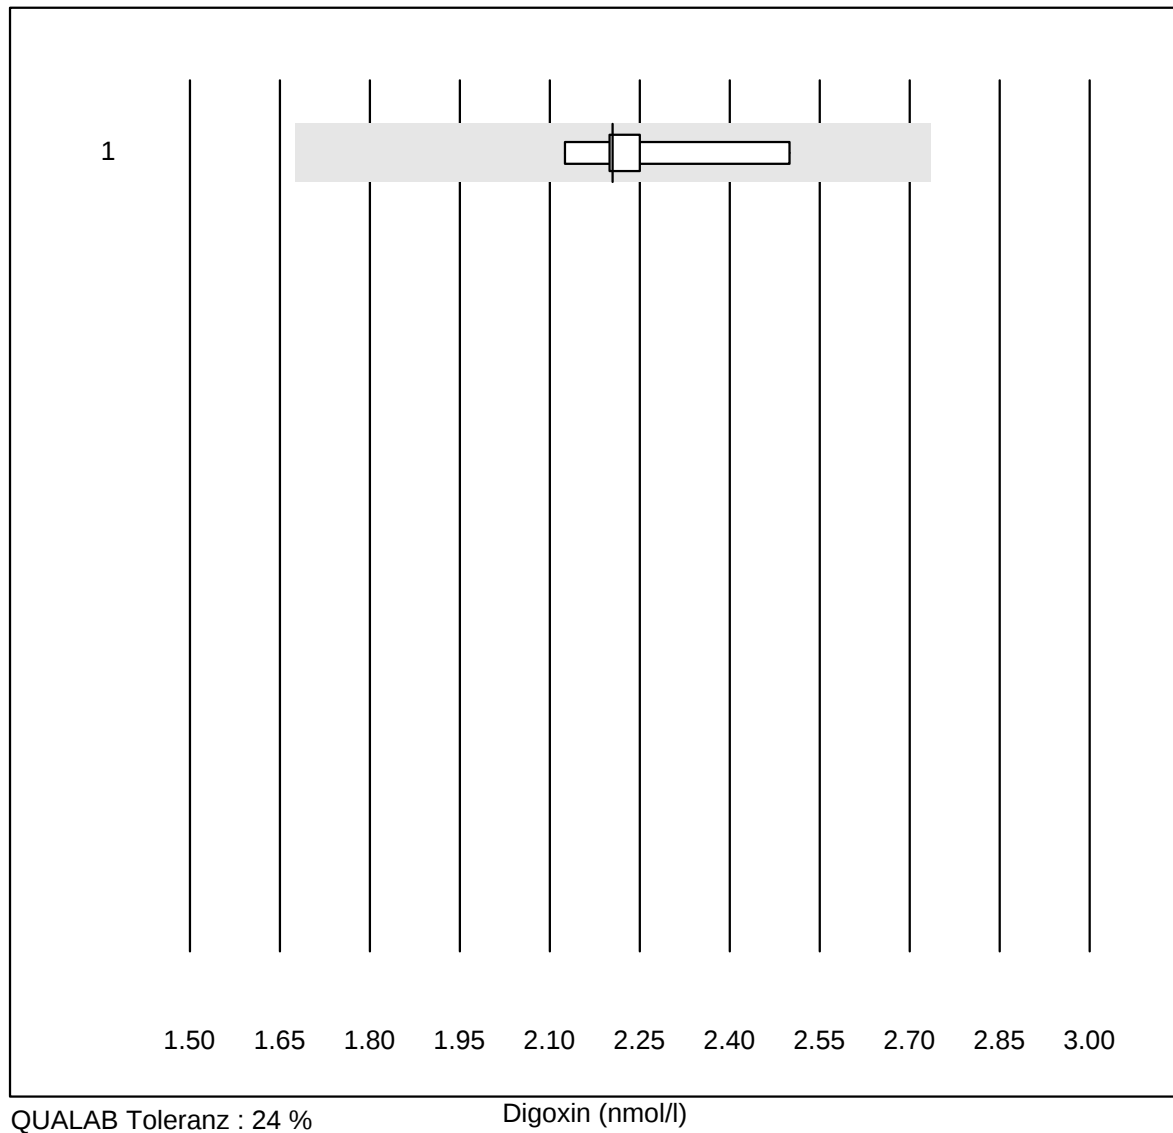

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Autres méthodes	6	100.0	0.0	0.0	2.21	5.8	e

Paracetamol

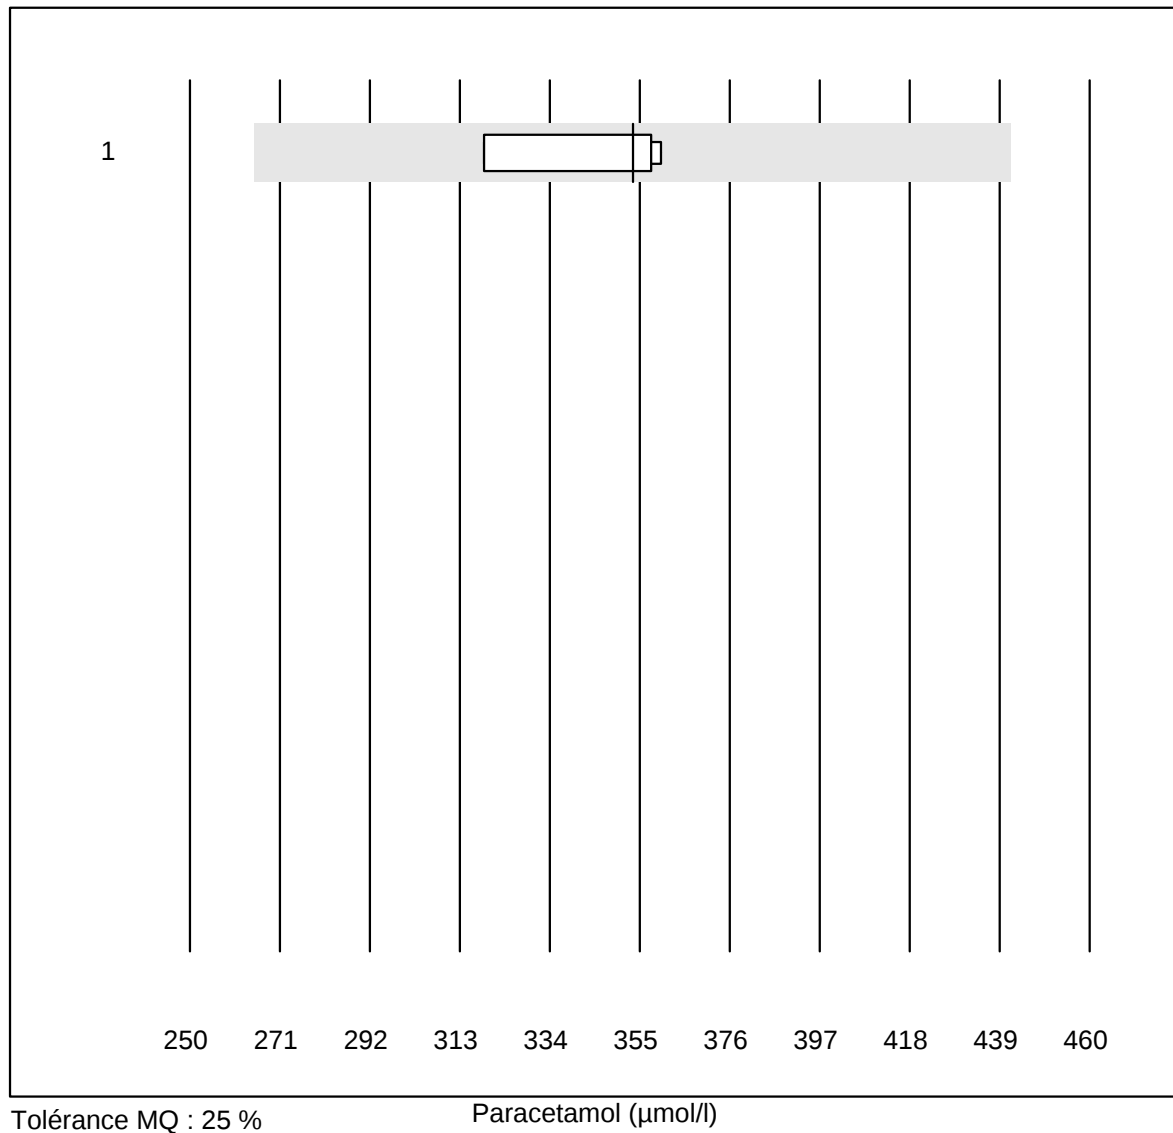


Tolérance MQ : 25 %

Paracetamol (μmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	353.4	5.5	e

Valproat

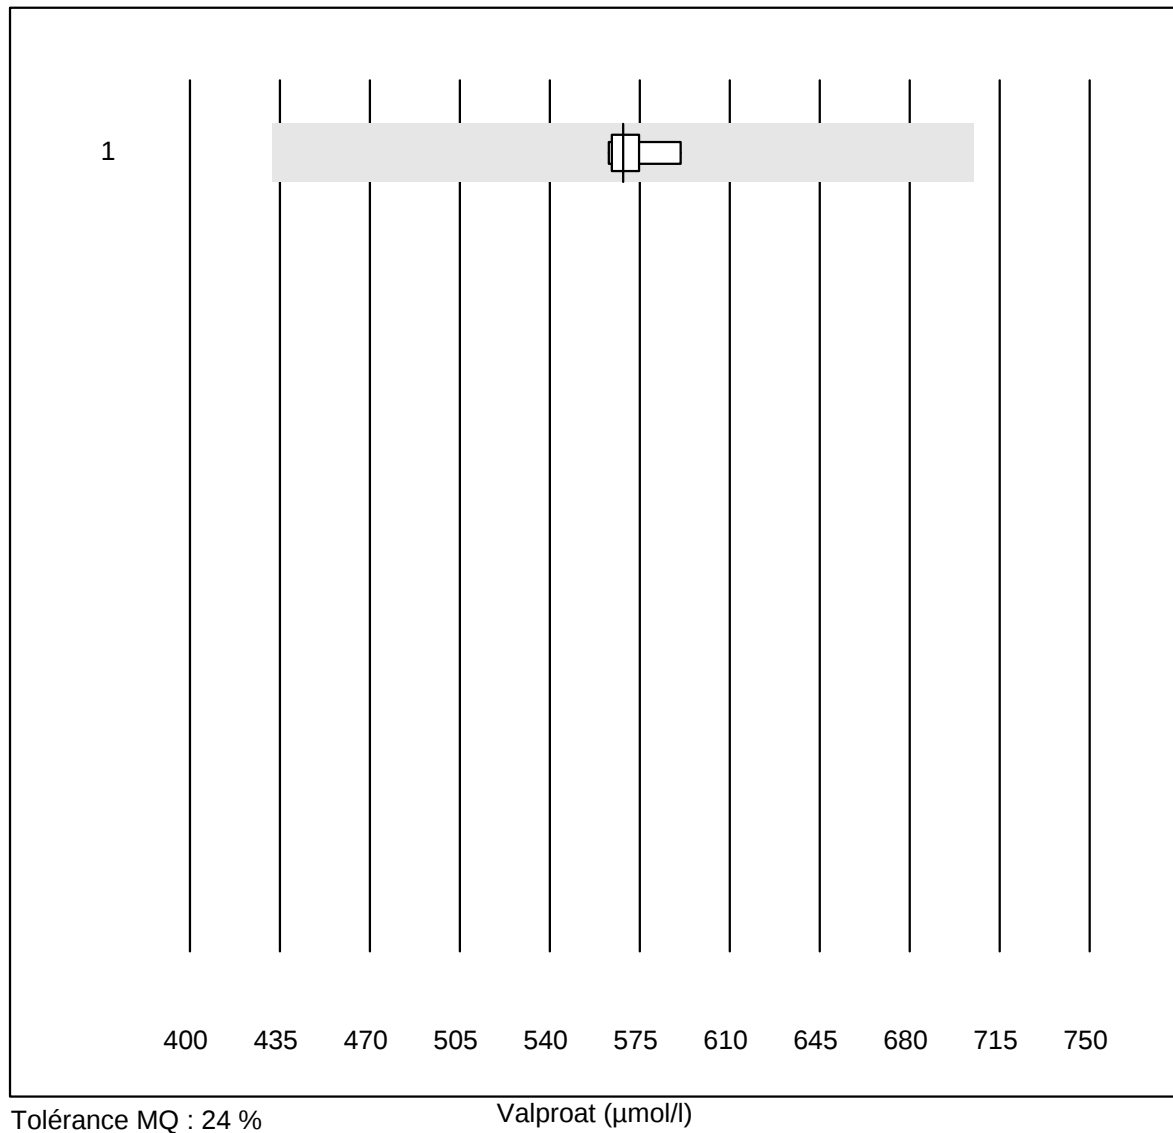


Tolérance MQ : 24 %

Valproat (µmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	568.5	1.9	e

Cystatin C

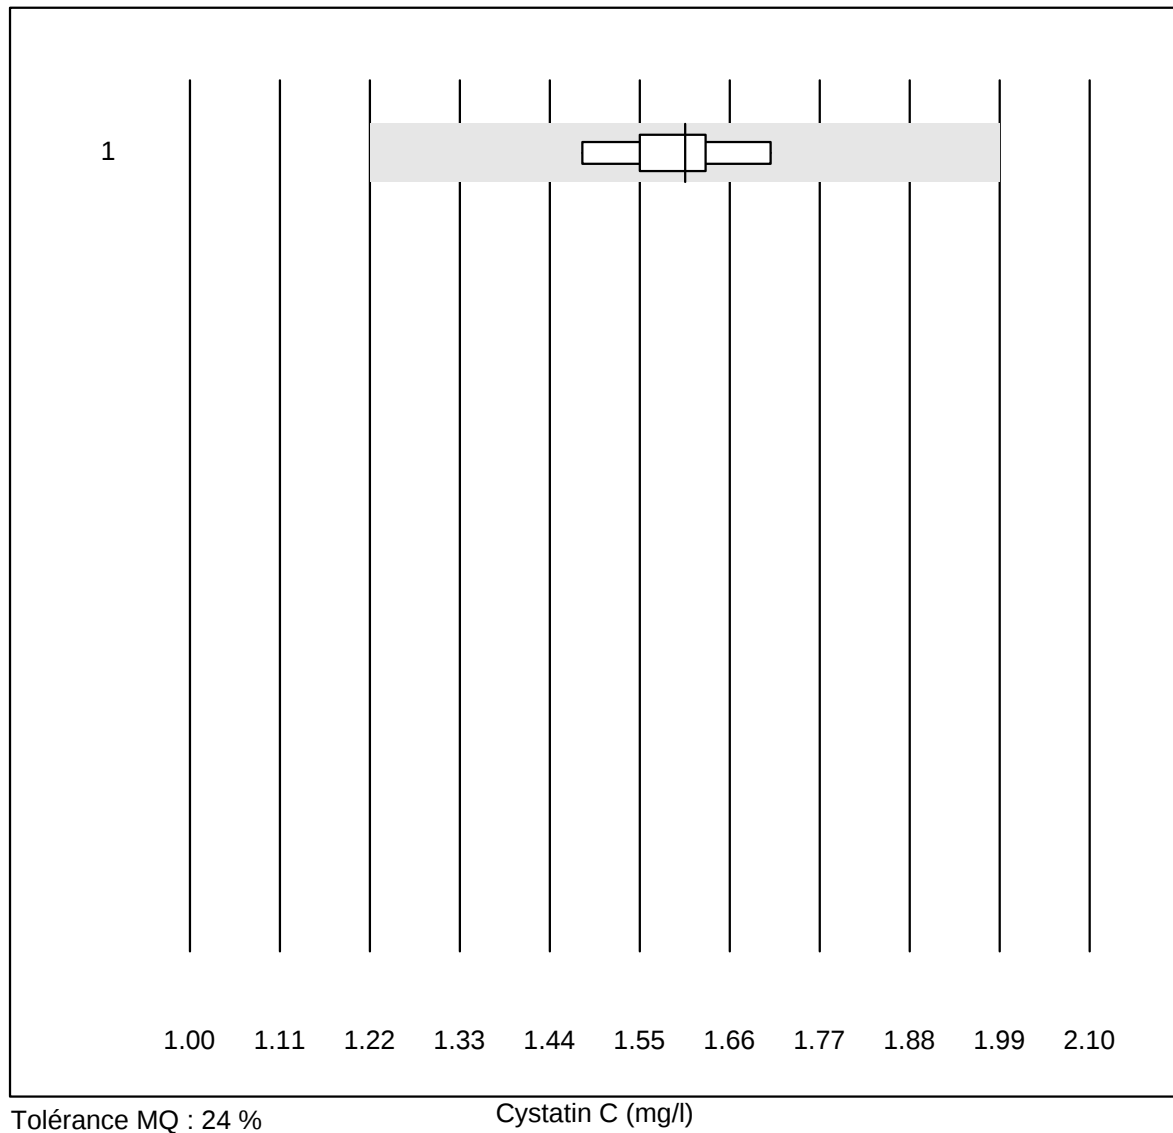


Tolérance MQ : 24 %

Cystatin C (mg/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	8	100.0	0.0	0.0	1.61	4.3	e

Éthanol

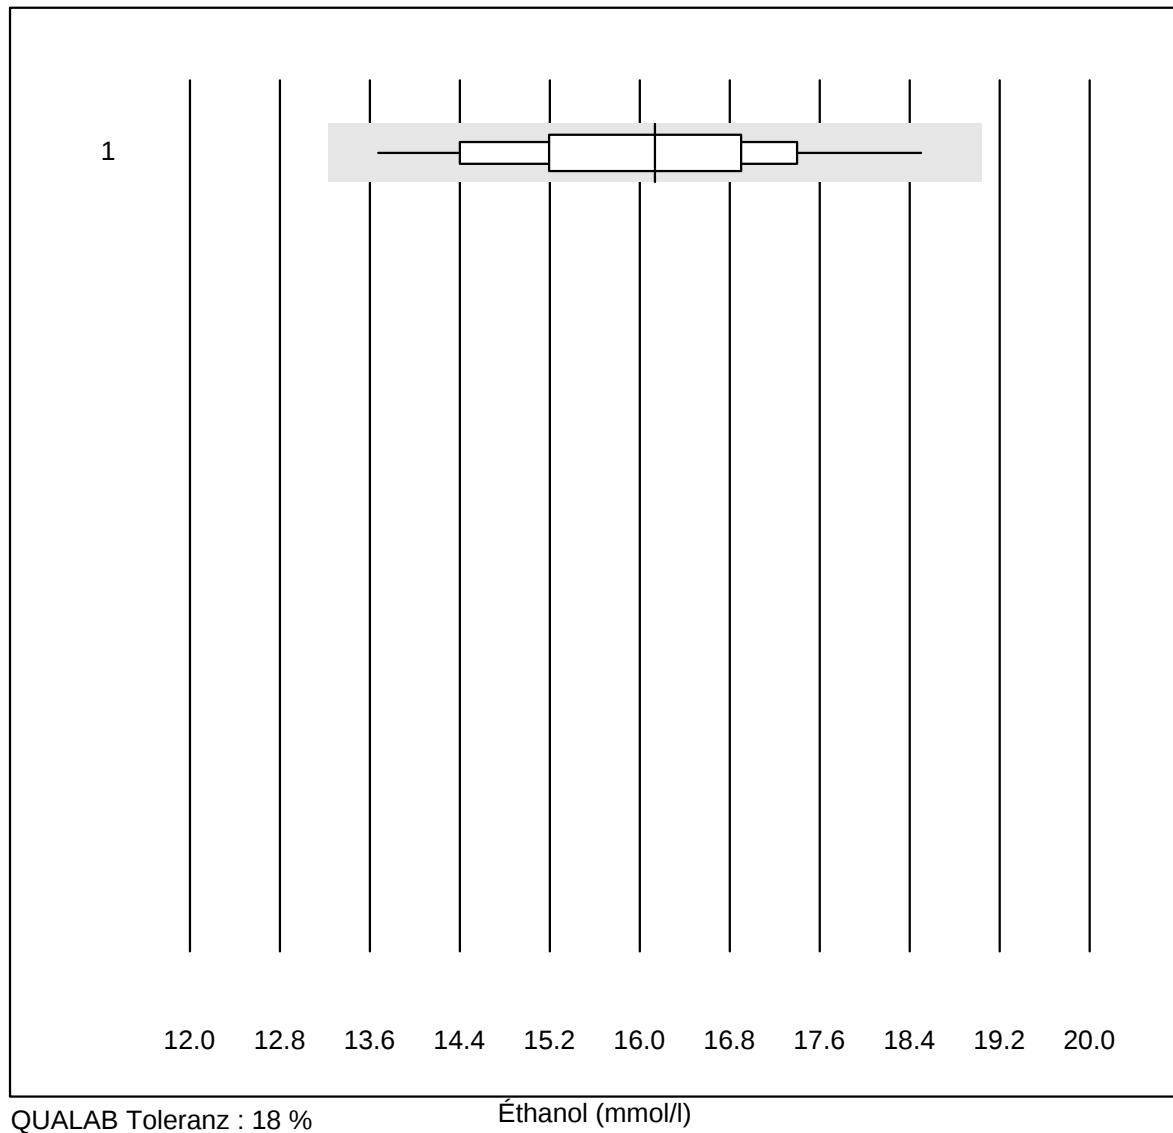

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	24	95.8	0.0	4.2	16.1	7.8	e

Ammoniac

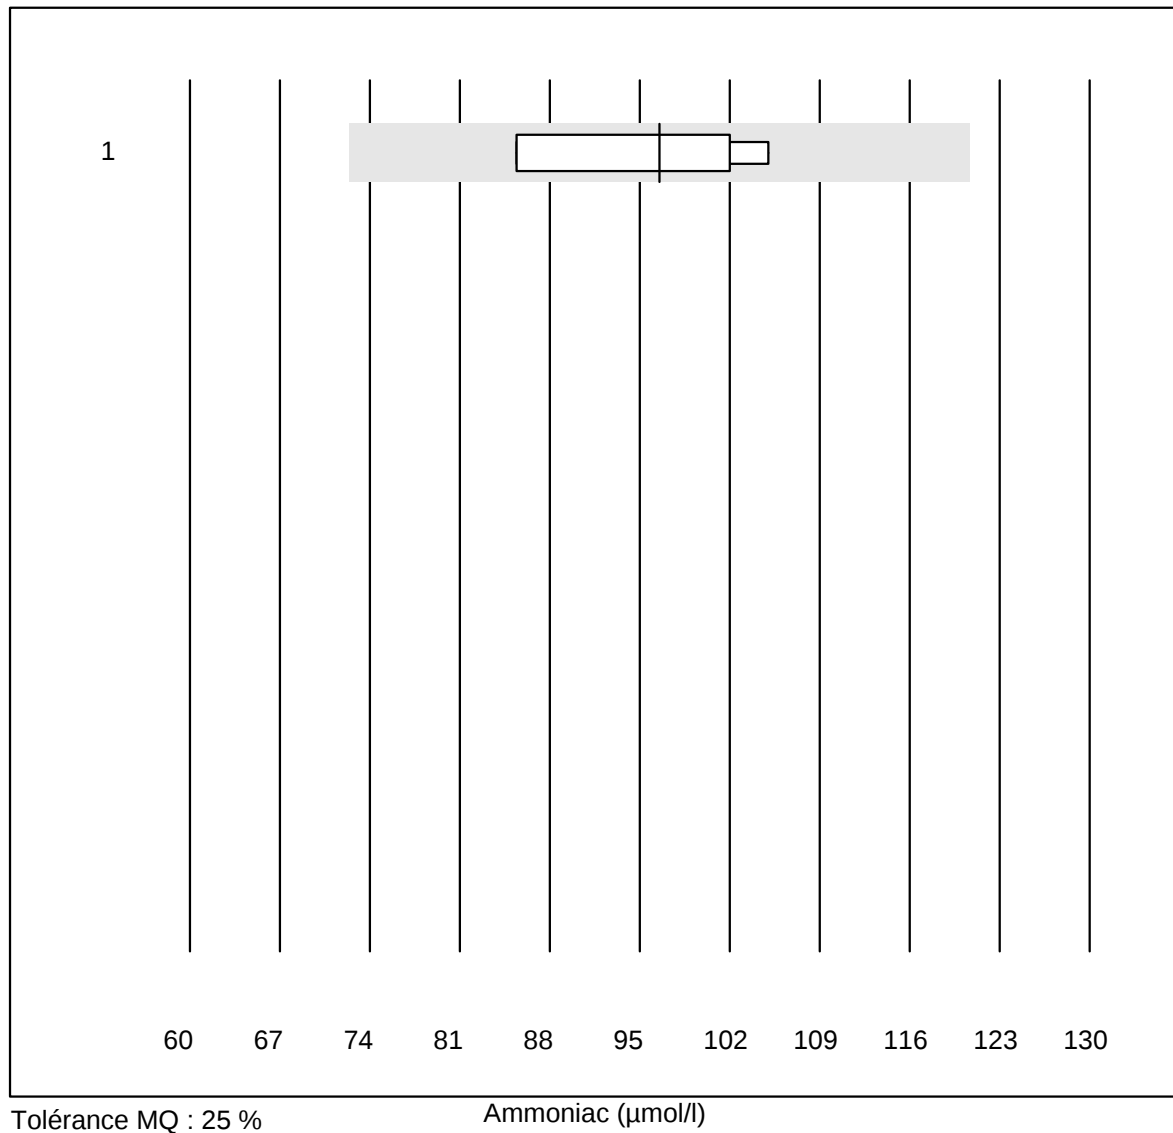


Tolérance MQ : 25 %

Ammoniac (μmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	96.5	9.6	e*

Calprotectine

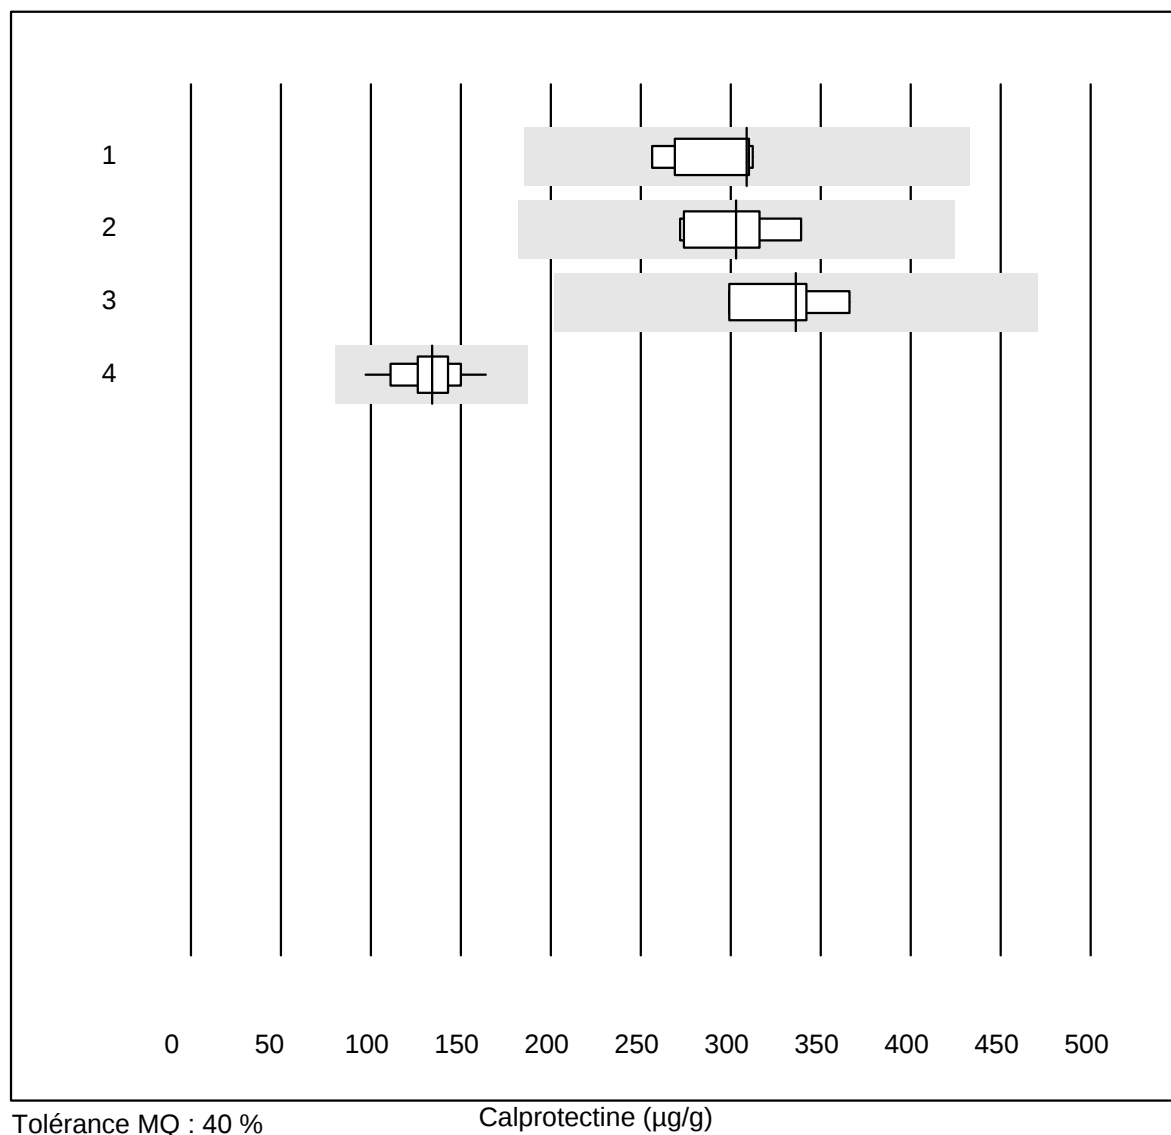


Tolérance MQ : 40 %

Calprotectine (µg/g)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Bühlmann ELISA	7	100.0	0.0	0.0	309	7.8	e
2	Bühlmann fCALturbo	9	77.8	0.0	22.2	303	8.2	e
3	Bühlmann Quantum Blu	4	100.0	0.0	0.0	336	8.3	e
4	Liaison	23	100.0	0.0	0.0	134	11.9	e

Cholestérol Af/b101

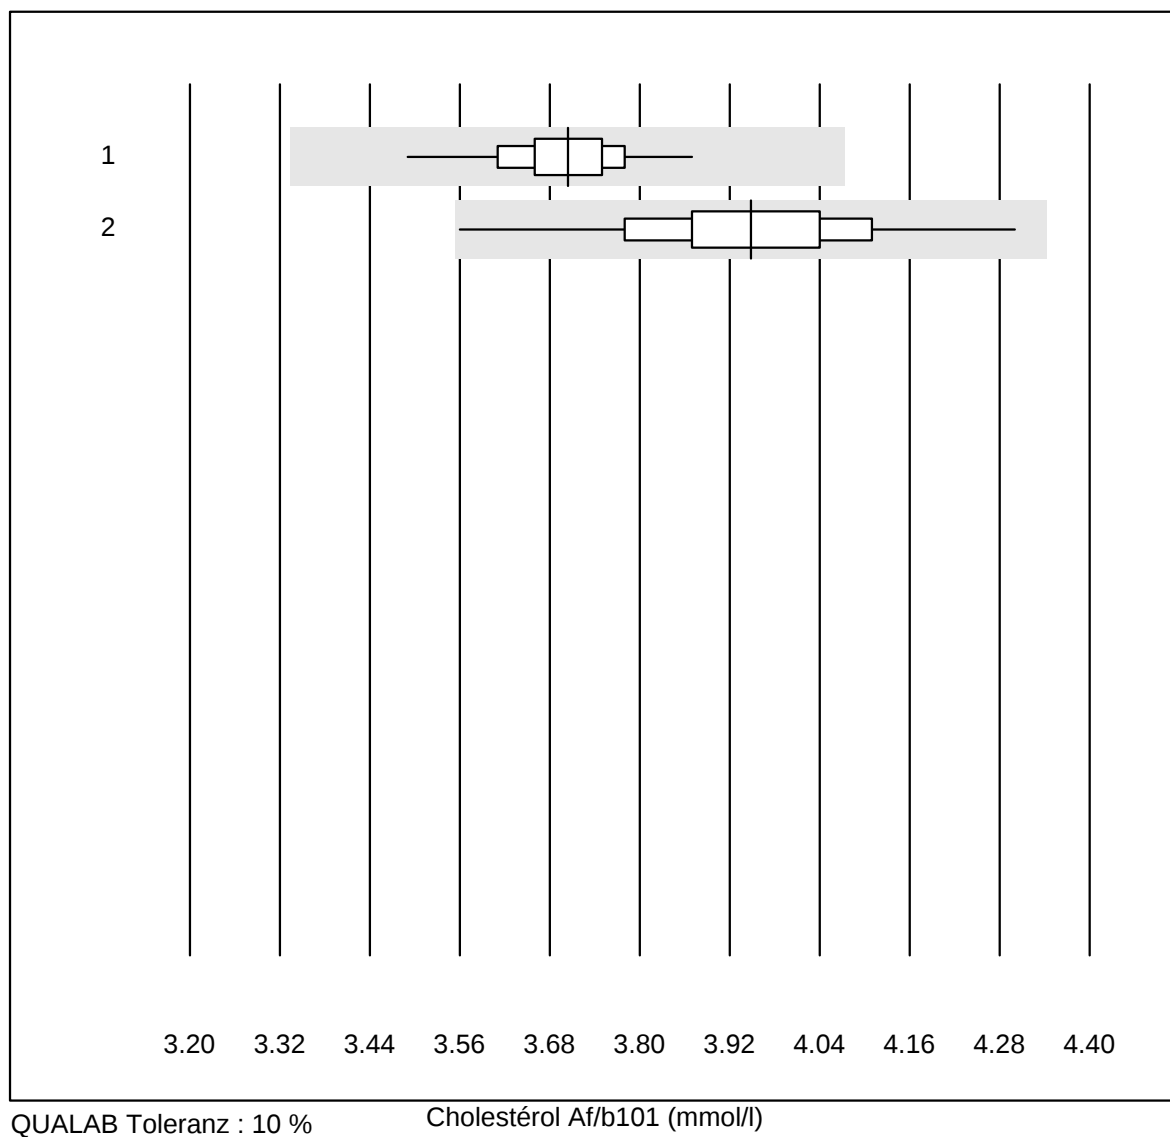

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas b101	178	99.4	0.0	0.6	3.70	1.8	e
2	Afinion	402	99.3	0.0	0.7	3.95	3.3	e

Cholestérol HDL Af/b101

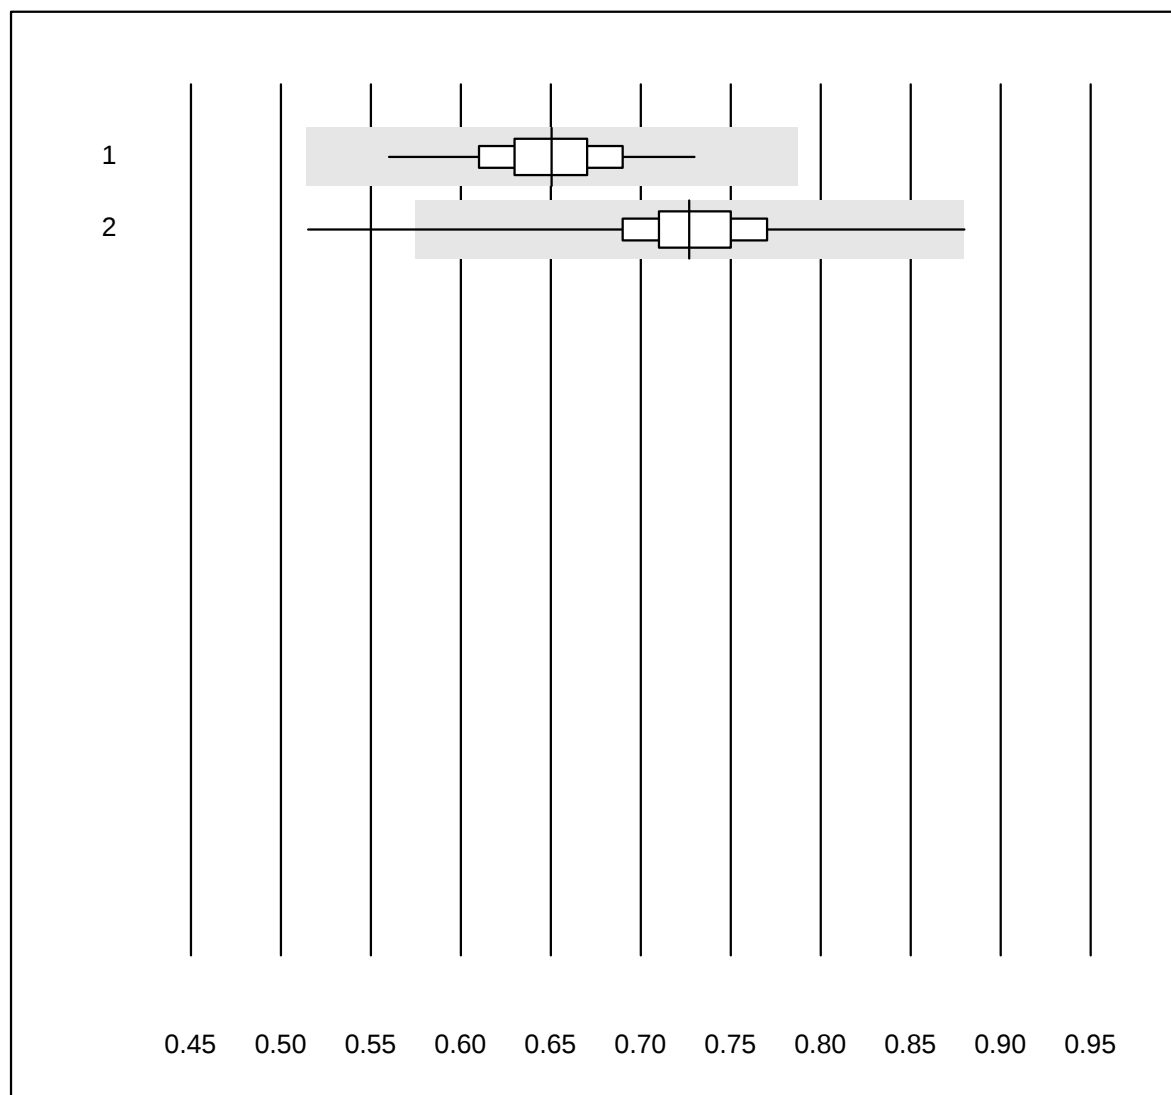


QUALAB Toleranz : 21 %

Cholestérol HDL Af/b101 (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas b101	178	96.6	0.0	3.4	0.65	5.1	e
2	Afinion	401	91.3	1.5	7.2	0.73	5.7	e

Triglycerides Af/b101

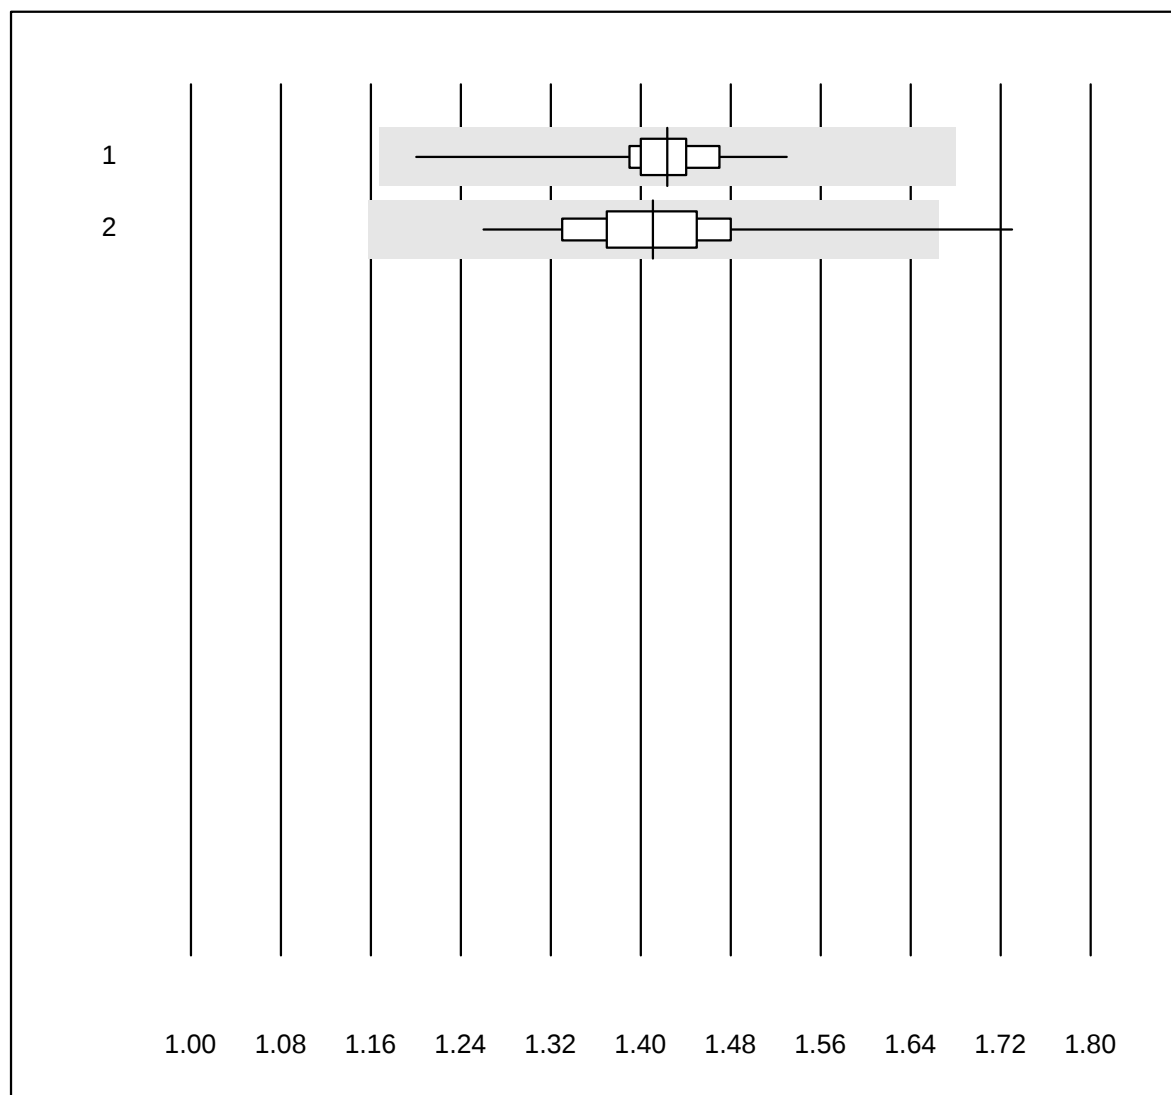


QUALAB Toleranz : 18 %

Triglycerides Af/b101 (mmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas b101	176	99.4	0.0	0.6	1.42	2.6	e
2	Afinion	402	99.1	0.2	0.7	1.41	4.4	e

Troponine I S

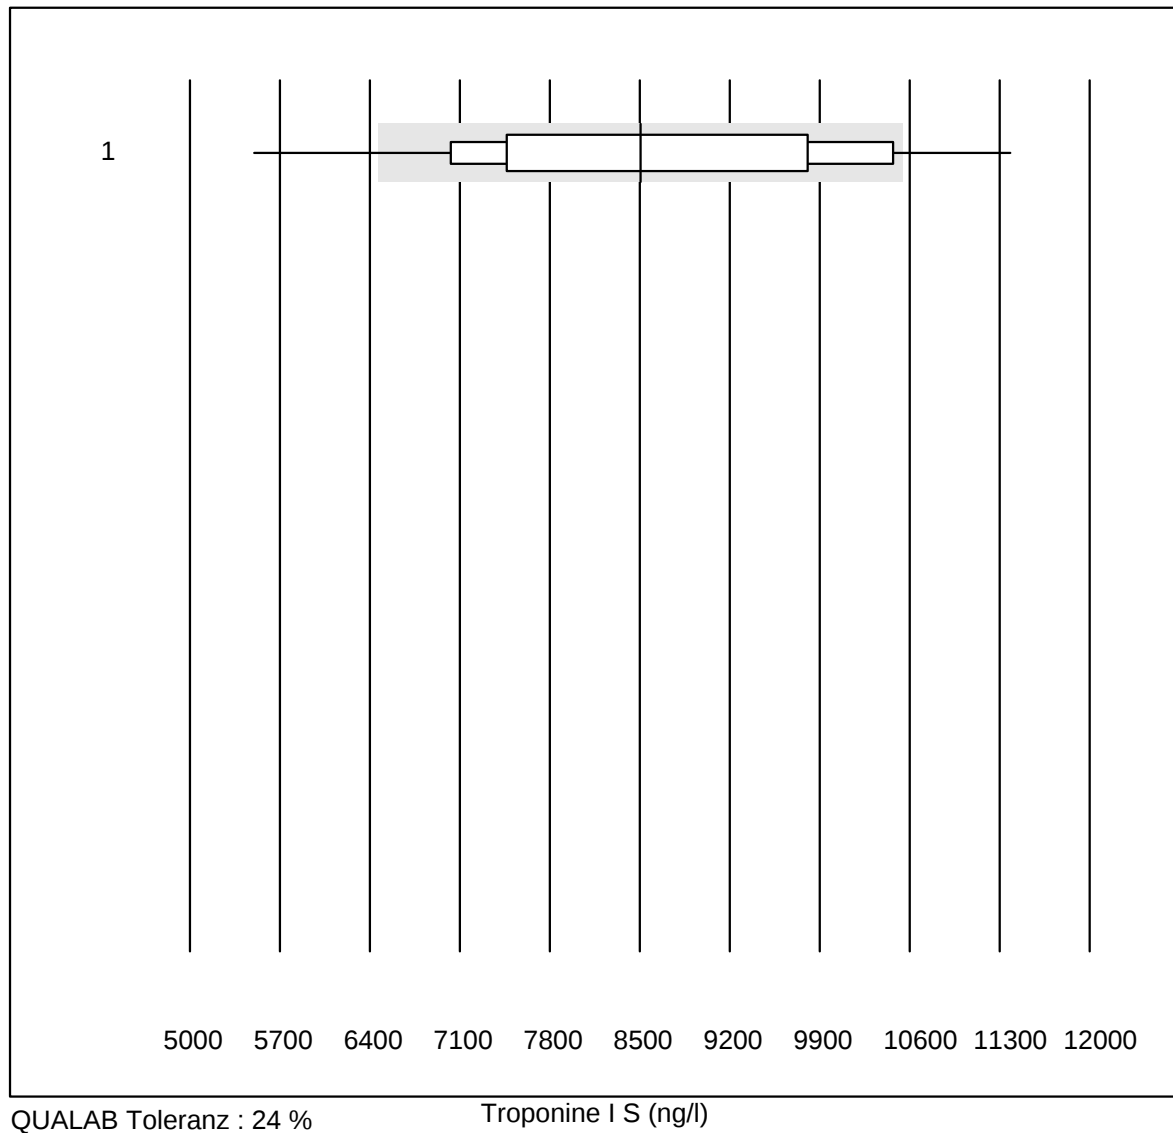


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 AFIAS	157	80.9	10.8	8.3	8504.51	16.4	e

D-Dimères qn S

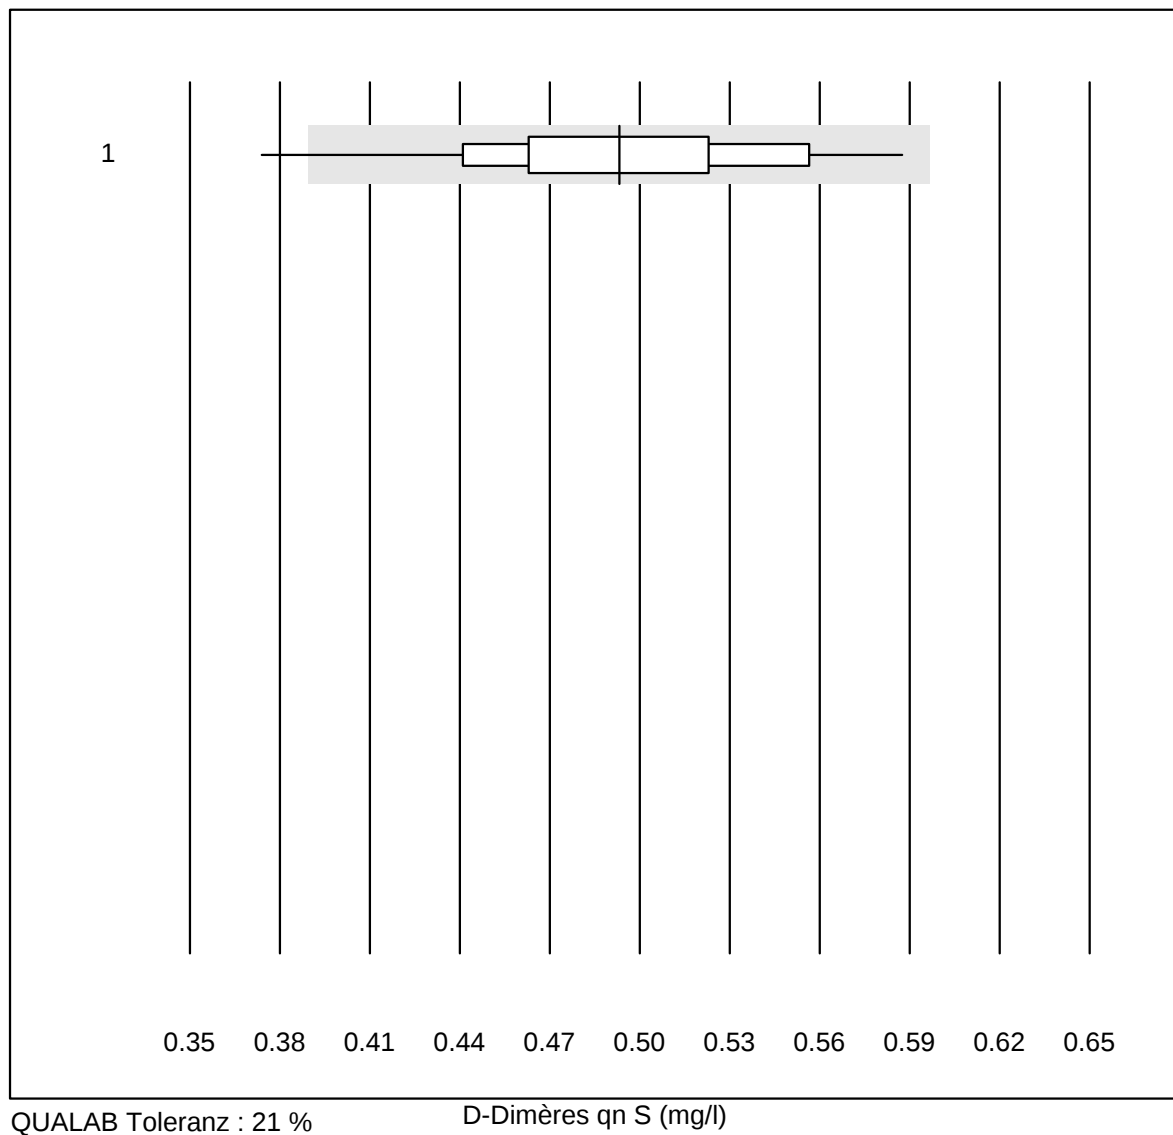


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 AFIAS	163	93.9	0.6	5.5	0.49	8.8	e

NT-proBNP S

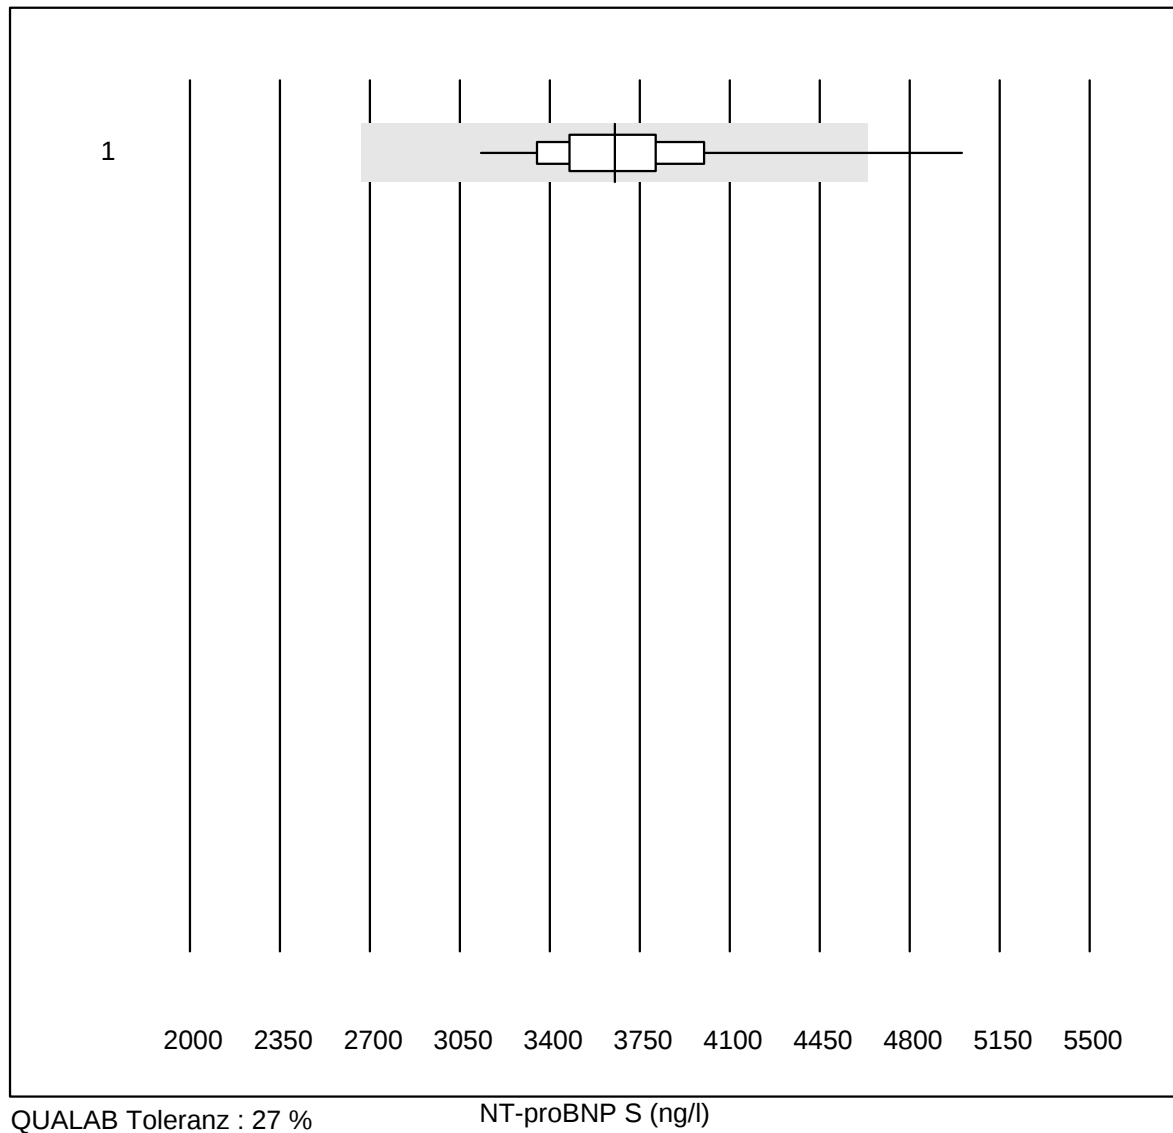

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 AFIAS	118	97.5	0.8	1.7	3653.1	7.5	e

Homocystein

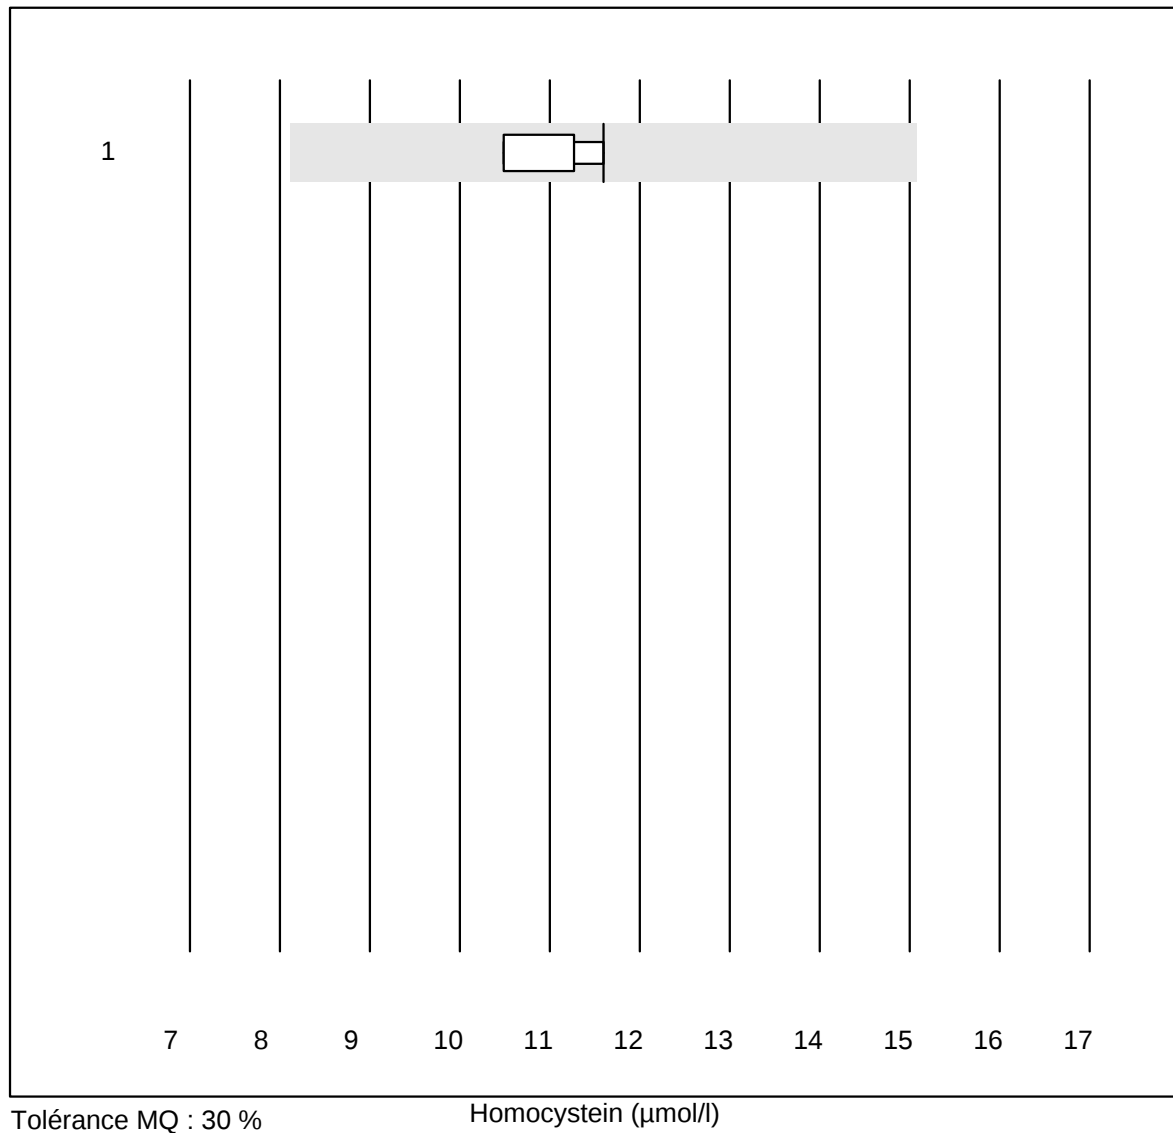


Tolérance MQ : 30 %

Homocystein (μmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	11.6	4.2	a

Lipase

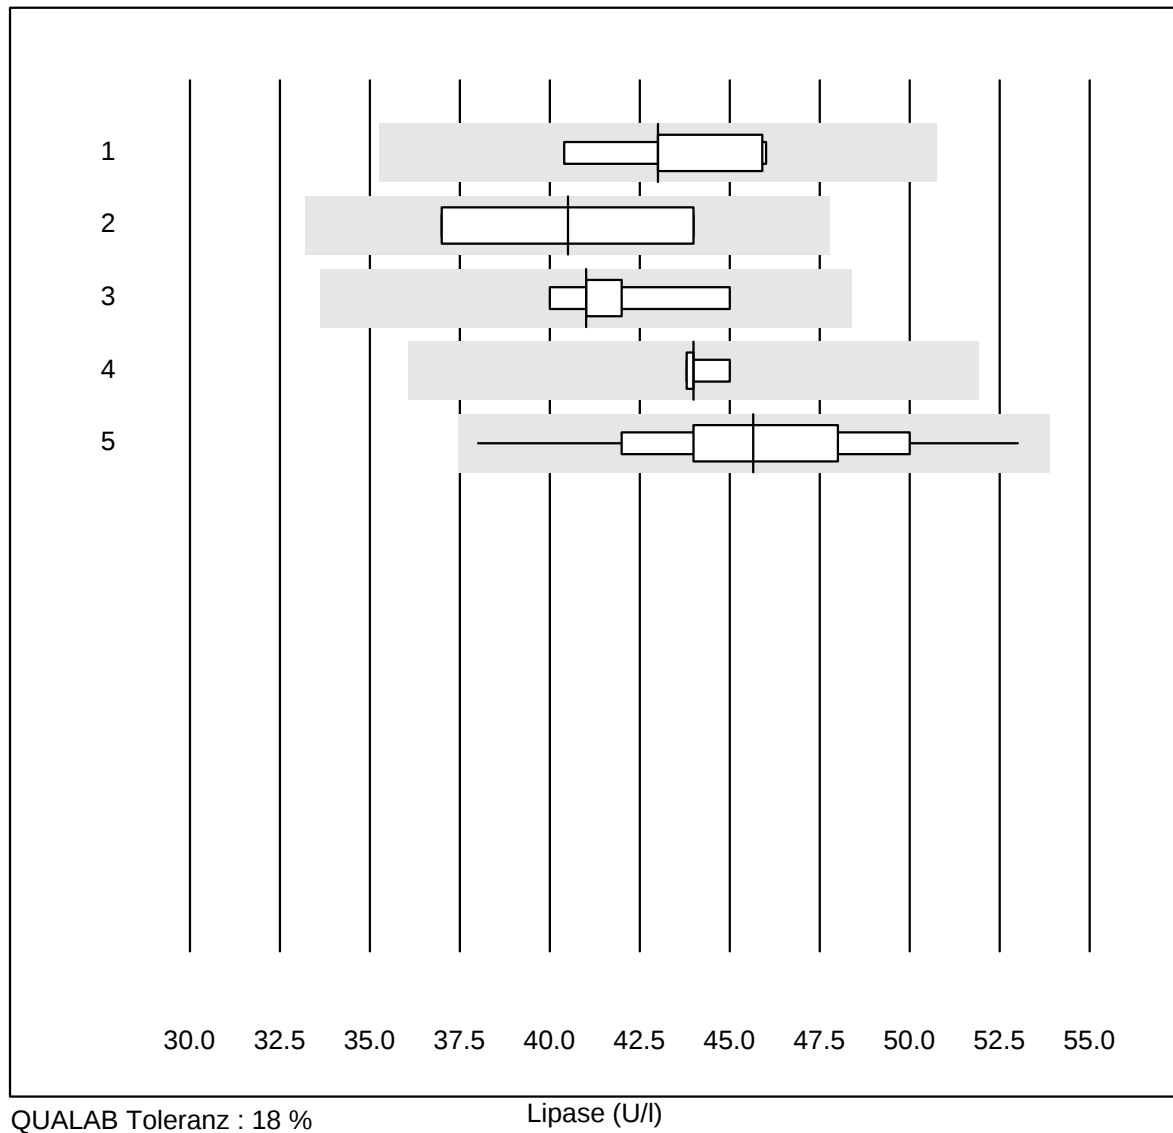


QUALAB Toleranz : 18 %

Lipase (U/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Roche	7	85.7	0.0	14.3	43.0	4.9	e
2	Architect	6	100.0	0.0	0.0	40.5	7.8	e*
3	Beckman	9	100.0	0.0	0.0	41.0	3.9	e
4	Cobas	4	100.0	0.0	0.0	44.0	1.2	e
5	Fuji Dri-Chem	141	100.0	0.0	0.0	45.7	6.8	e

Cholinestérase

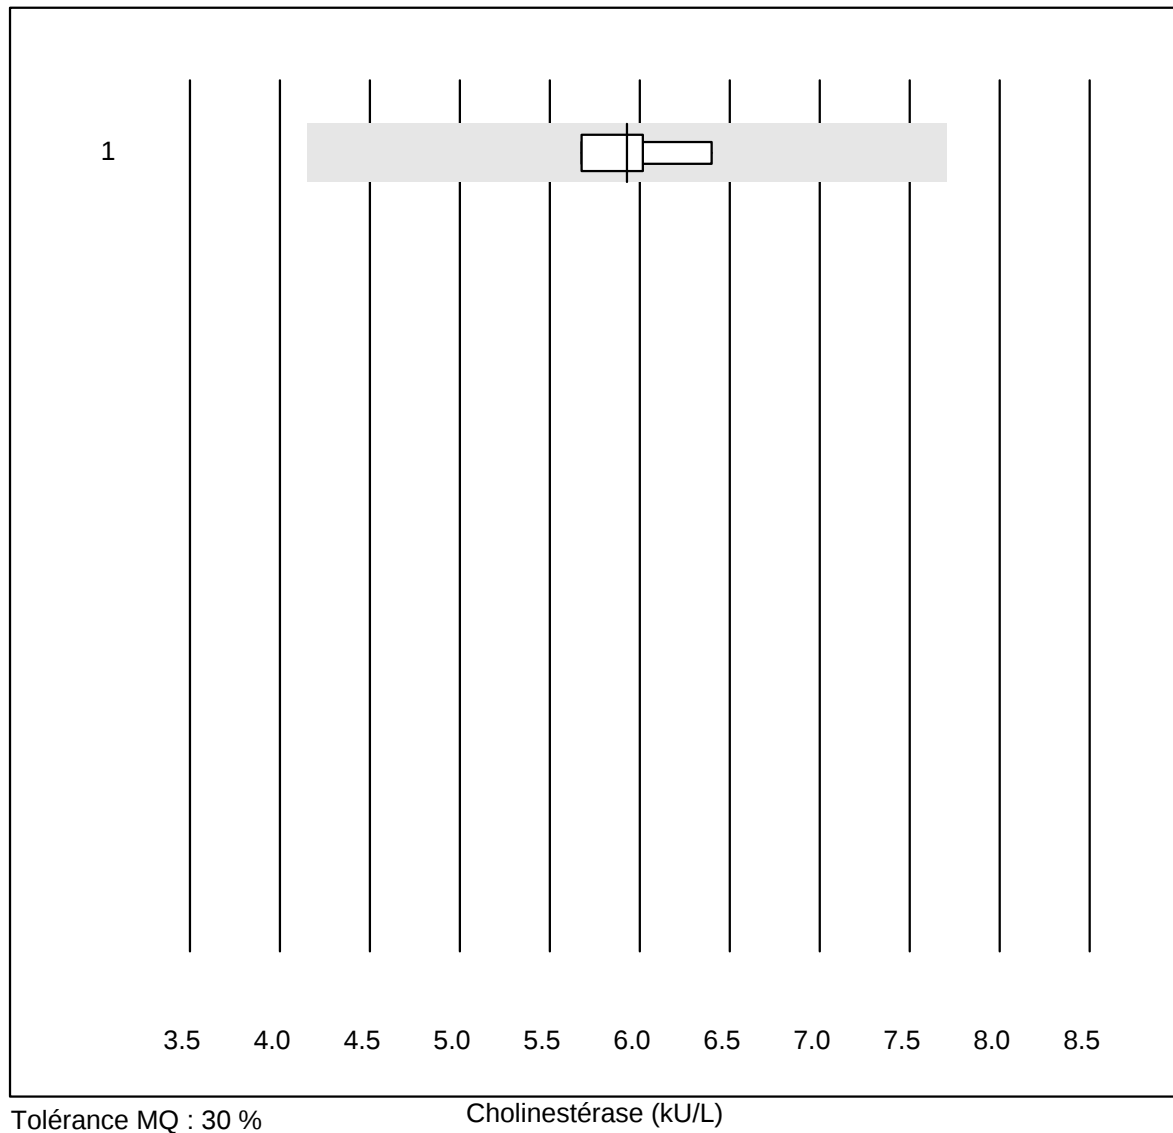

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	5.9	5.2	e

Glucose CSF

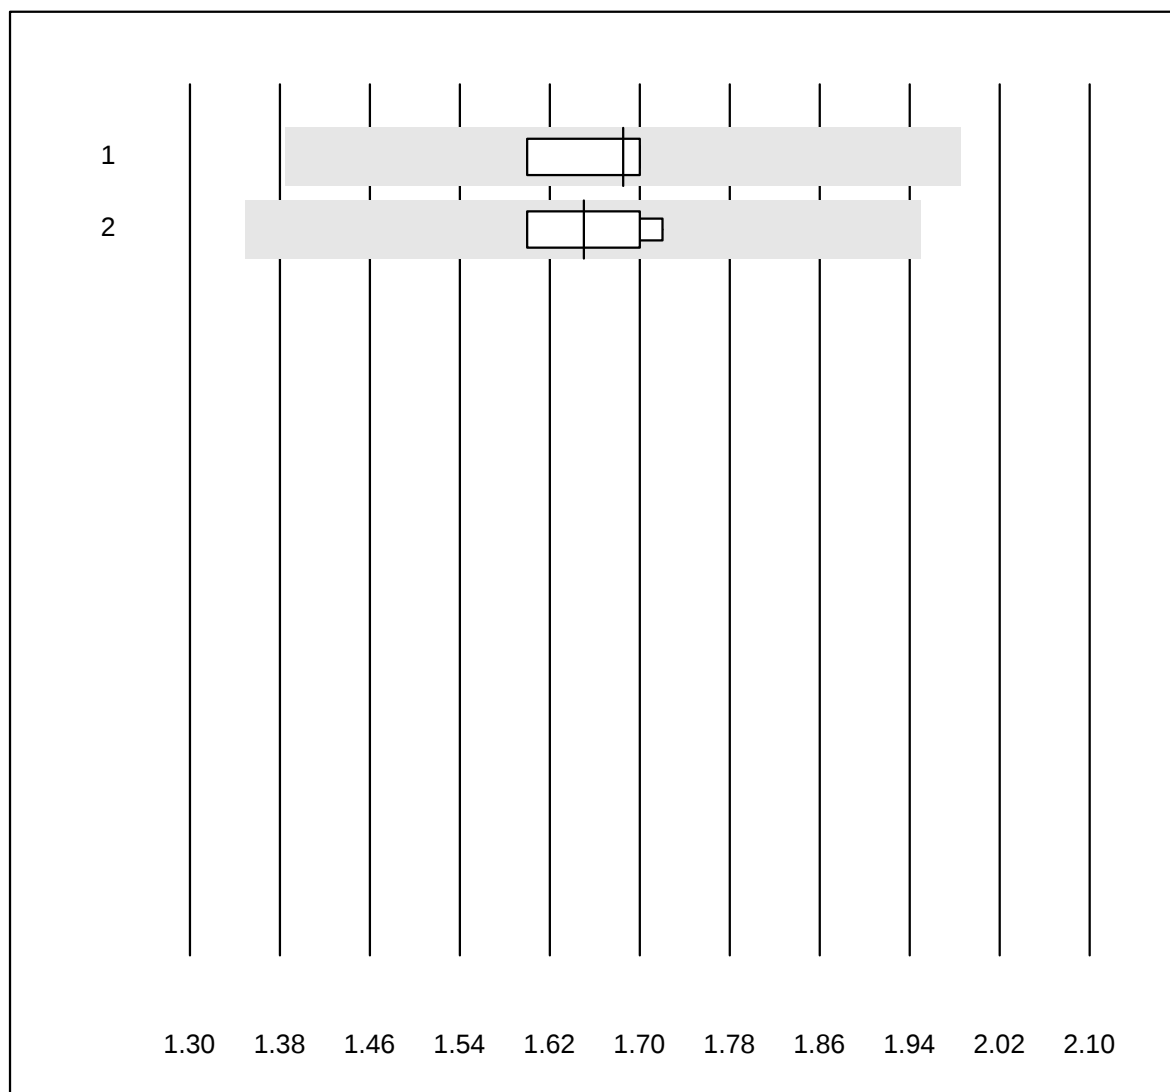


QUALAB Toleranz : 9 %
(< 3.30: +/- 0.30 mmol/l)

Glucose CSF (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	1.69	2.8	e*
2 Autres méthodes	8	100.0	0.0	0.0	1.65	3.4	e*

Lactate CSF

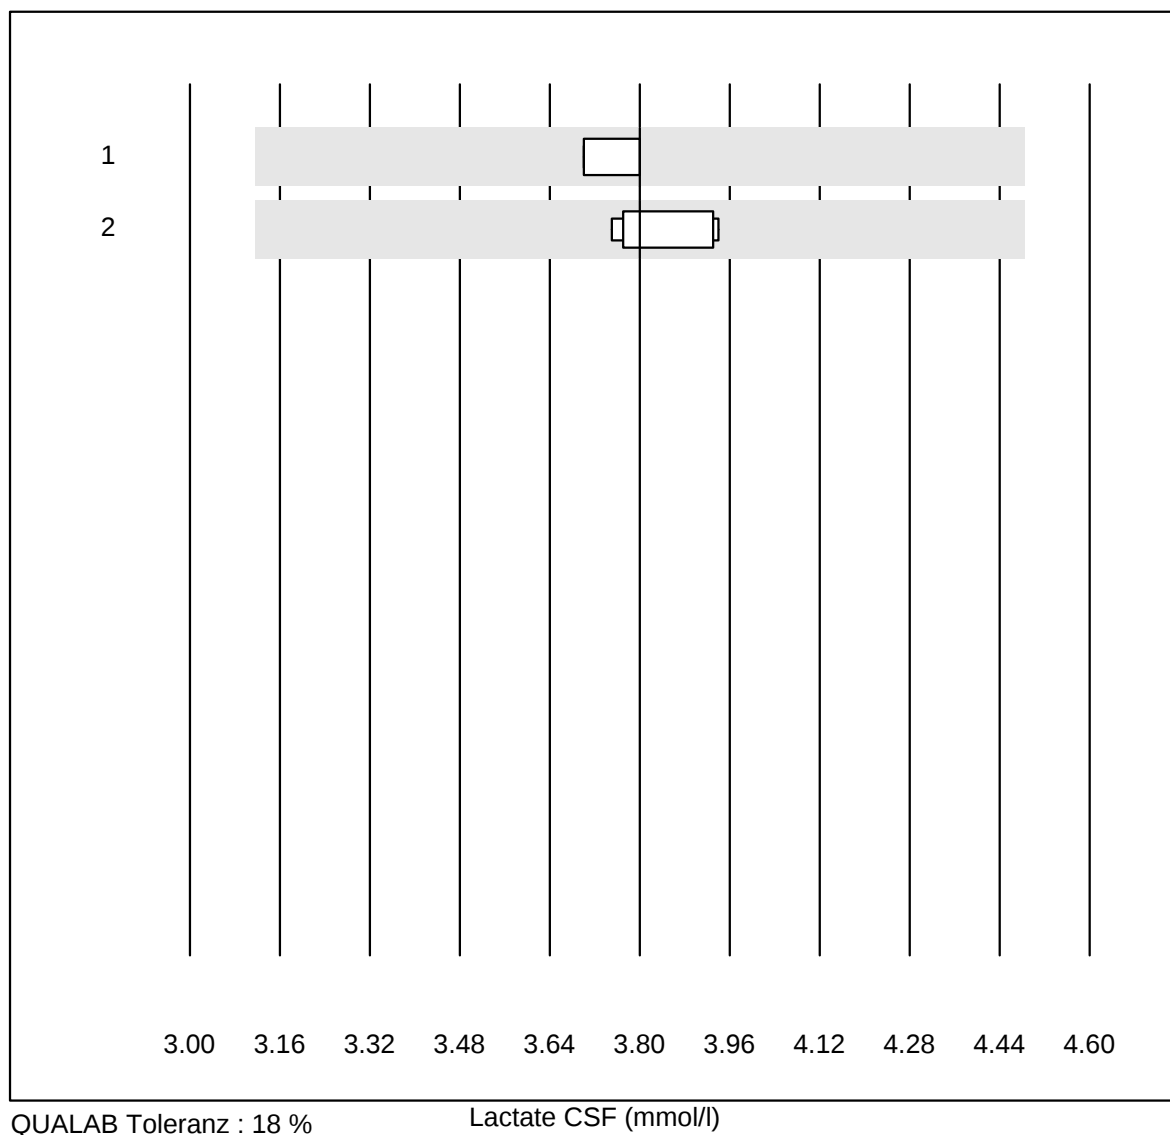


QUALAB Toleranz : 18 %

Lactate CSF (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas	4	100.0	0.0	0.0	3.80	1.3	e
2	Autres méthodes	6	100.0	0.0	0.0	3.80	2.1	e

Protéine CSF

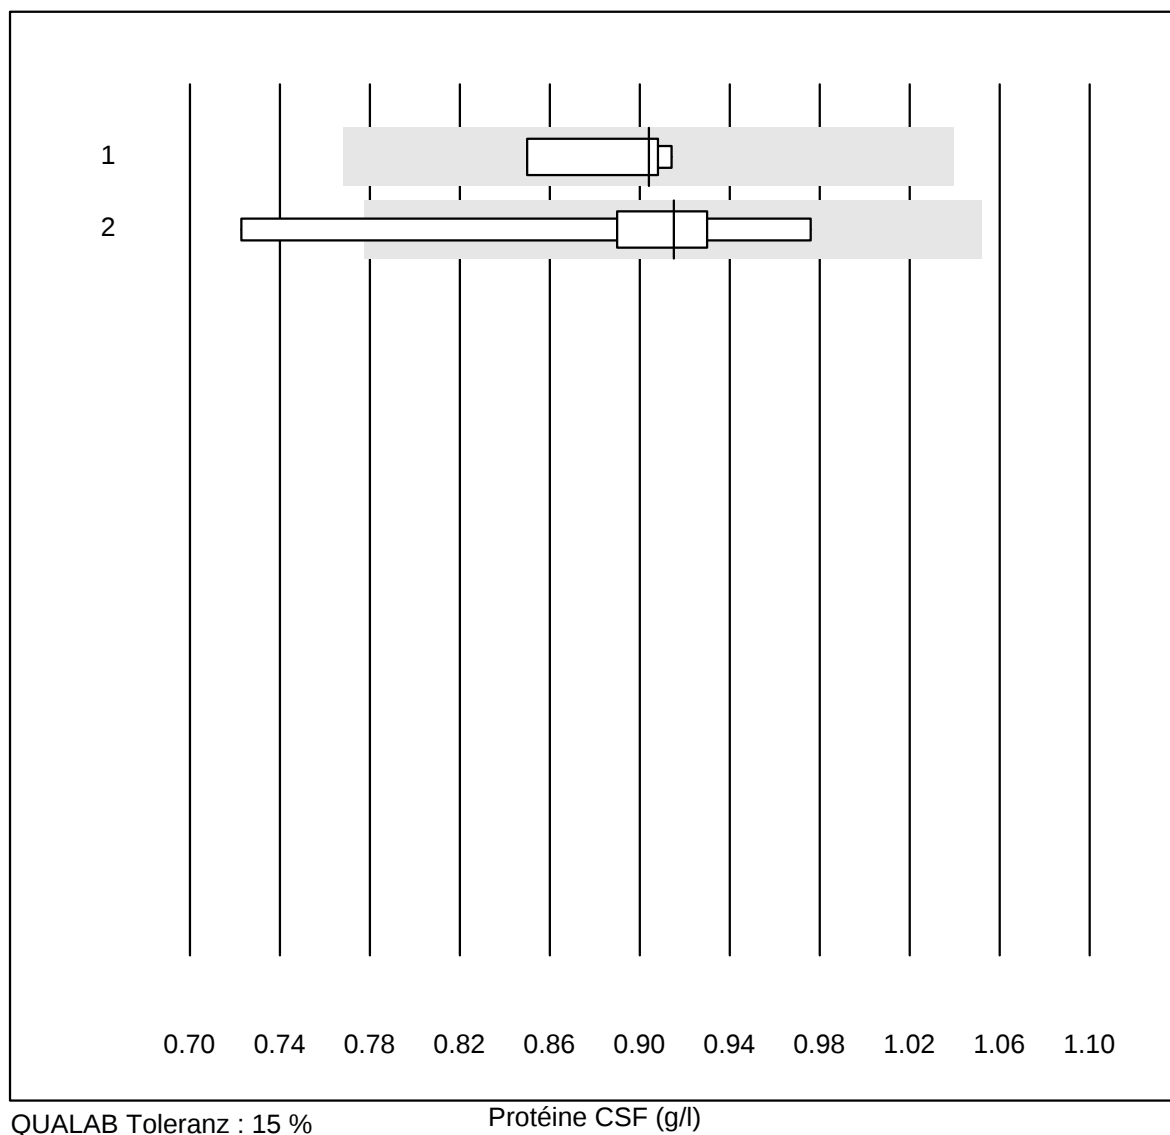


QUALAB Toleranz : 15 %

Protéine CSF (g/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas	4	100.0	0.0	0.0	0.90	3.3	e
2	Autres méthodes	6	83.3	16.7	0.0	0.92	9.9	e*

Tacrolimus

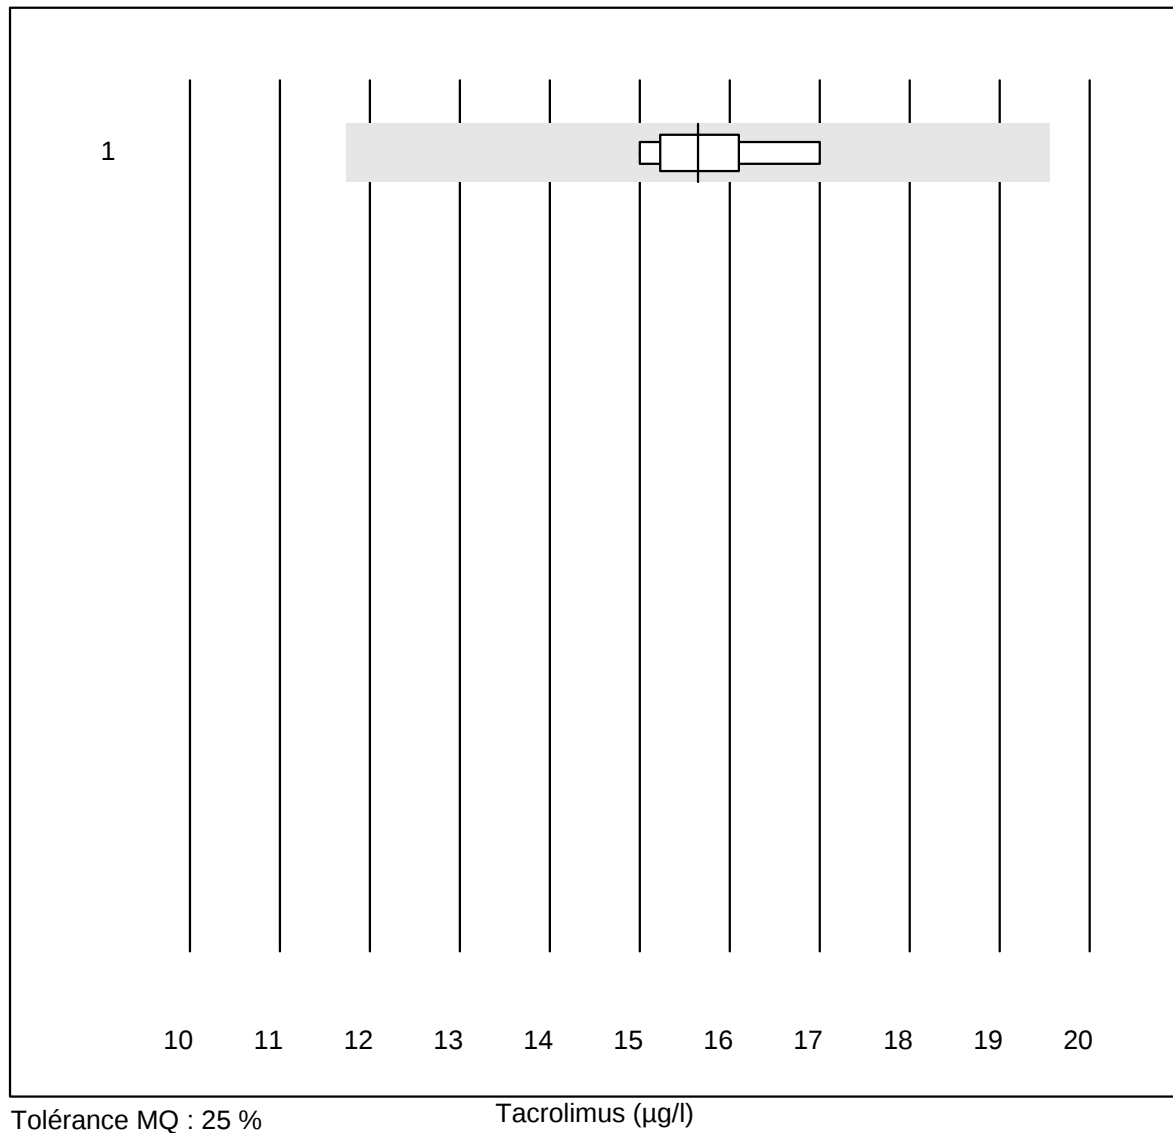


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	8	100.0	0.0	0.0	15.7	4.2	e

Totalprotein E

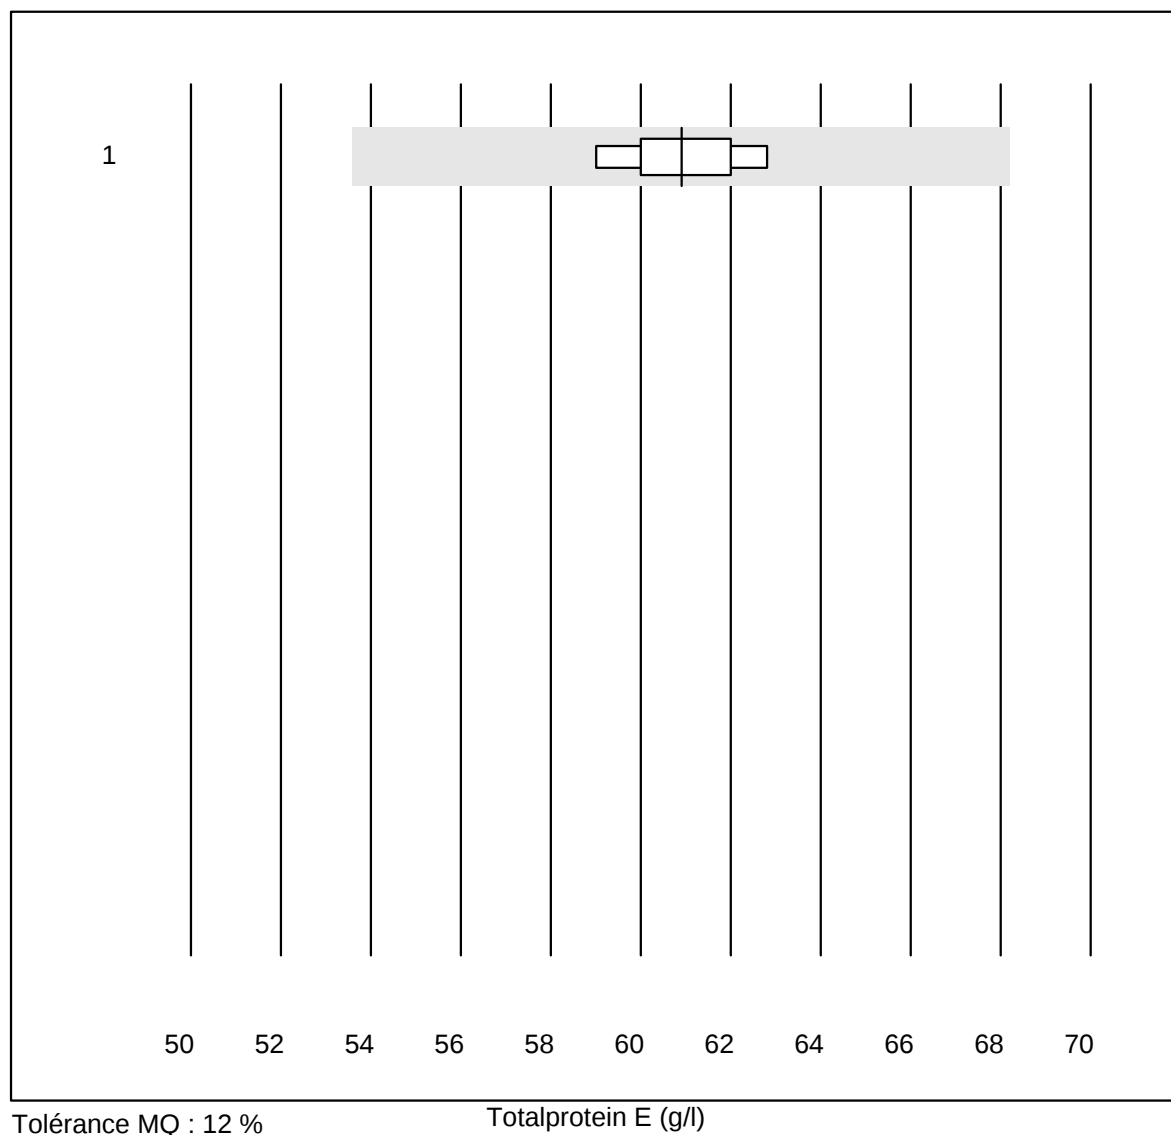


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	60.9	2.2	e

Albumin E

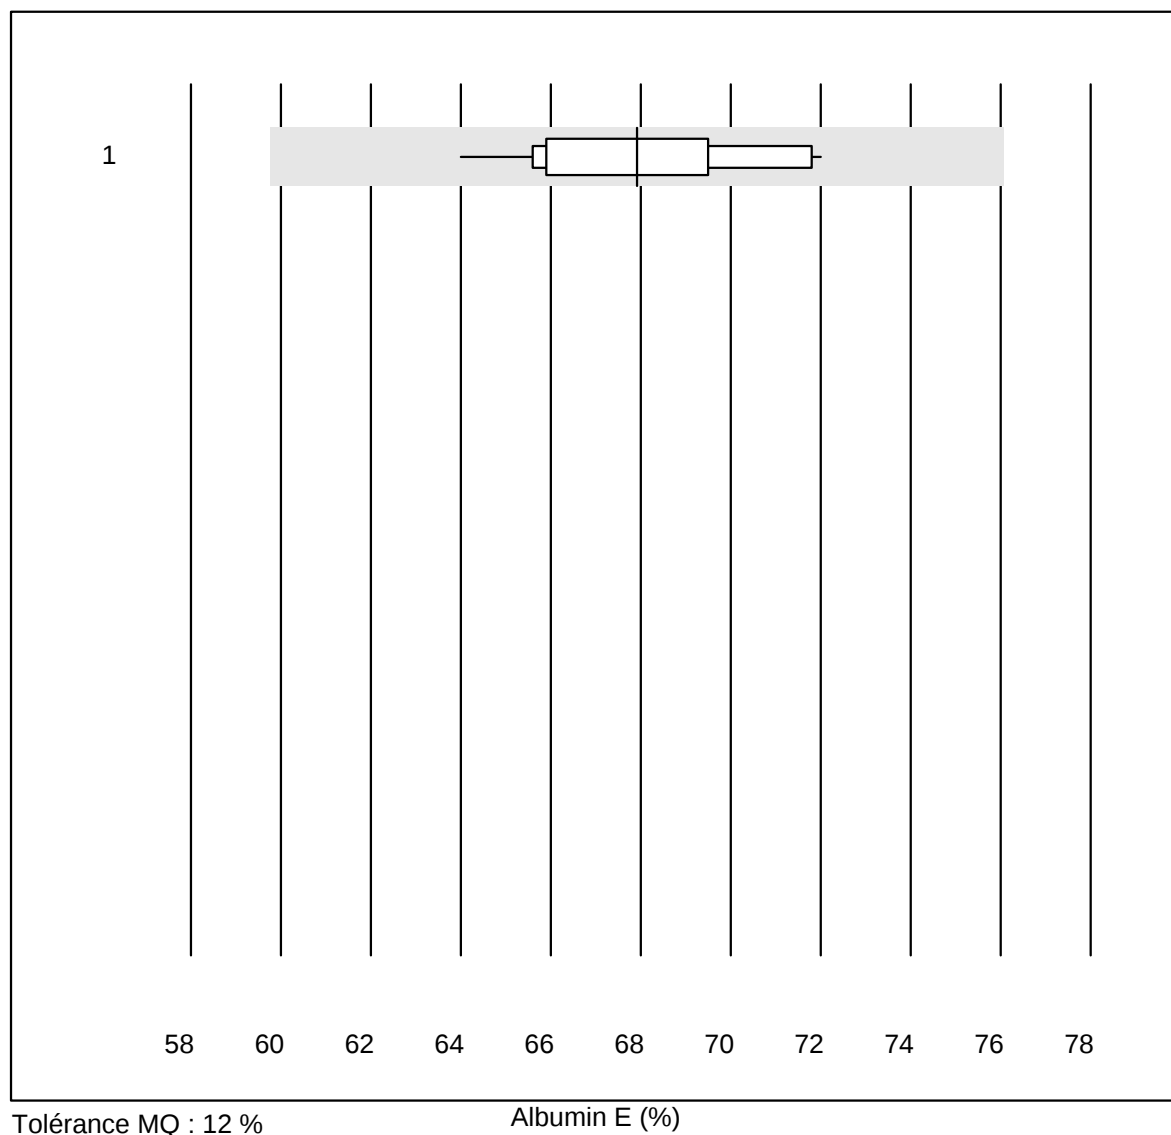


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 électrophorèse	11	100.0	0.0	0.0	67.9	3.6	e

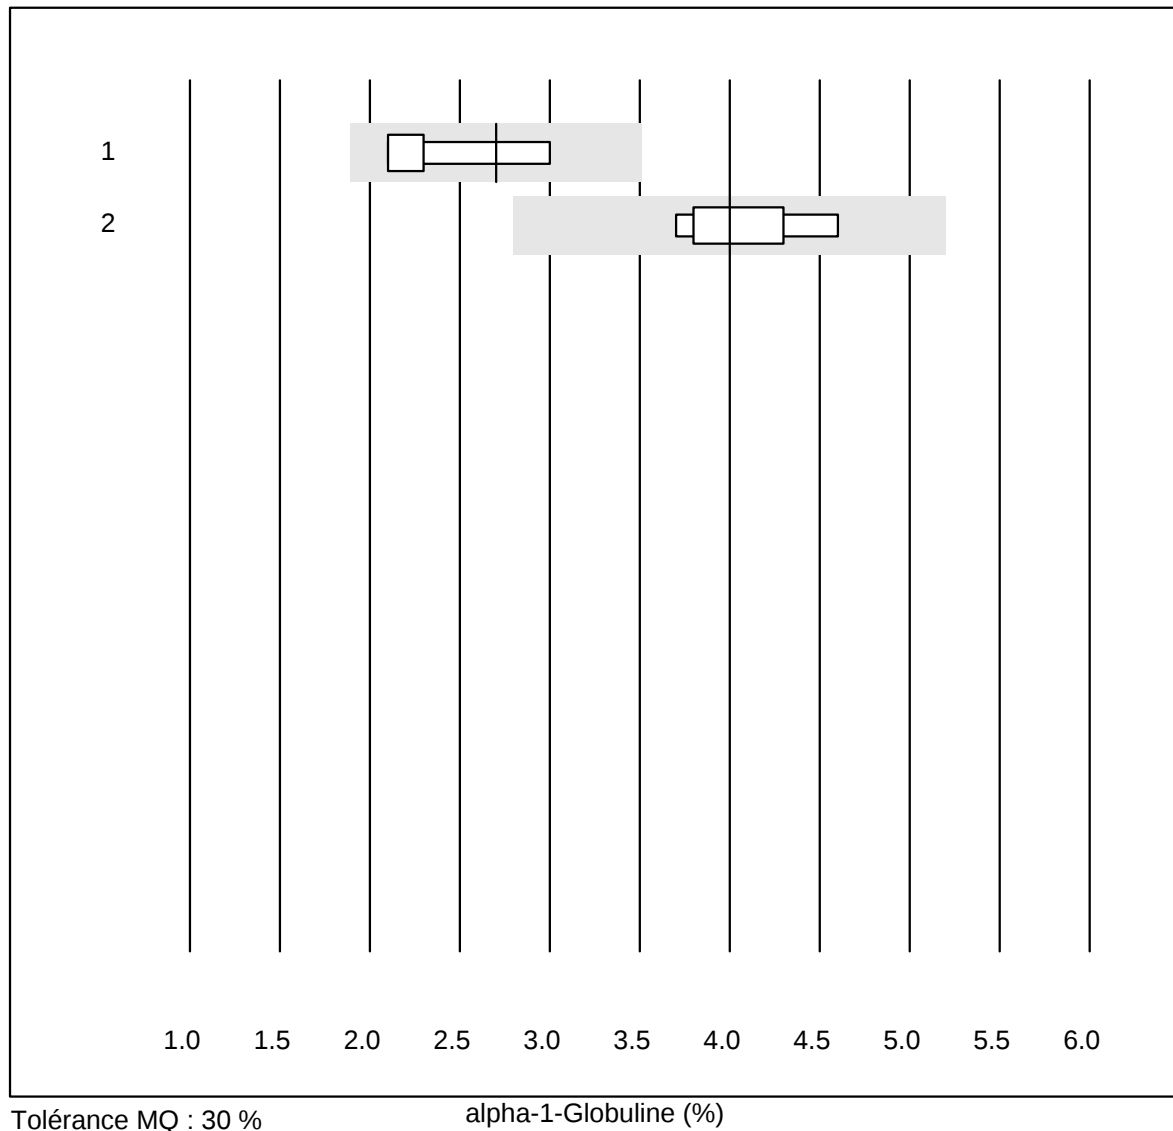
alpha-1-Globuline

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 électrophorèse	4	100.0	0.0	0.0	2.7	17.0	a
2 électrophorèse capil	7	100.0	0.0	0.0	4.0	7.6	e

alpha-2-Globuline

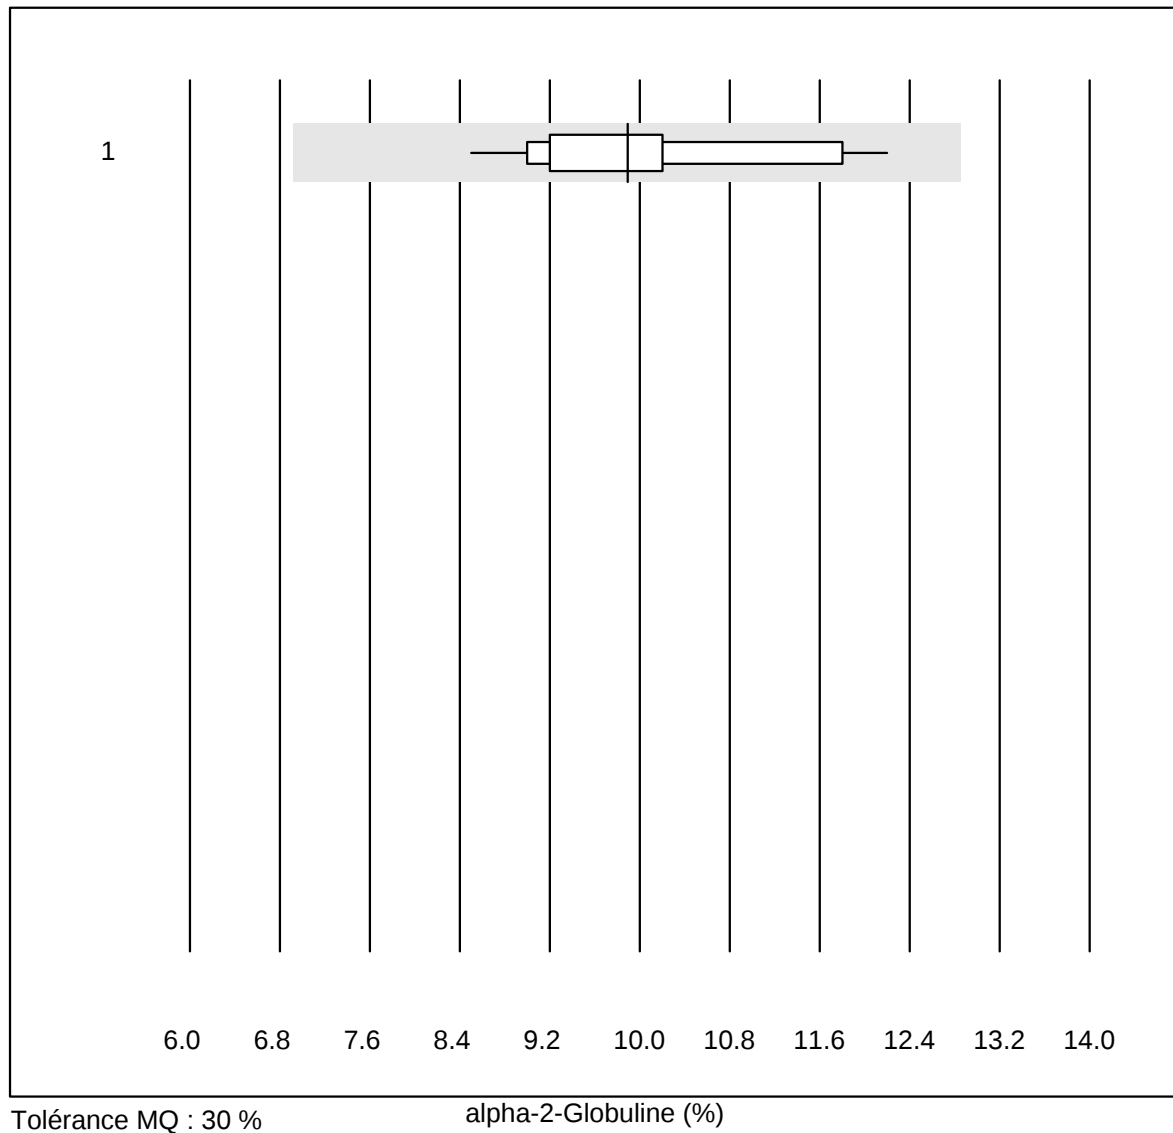


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 électrophorèse	11	100.0	0.0	0.0	9.9	11.6	e

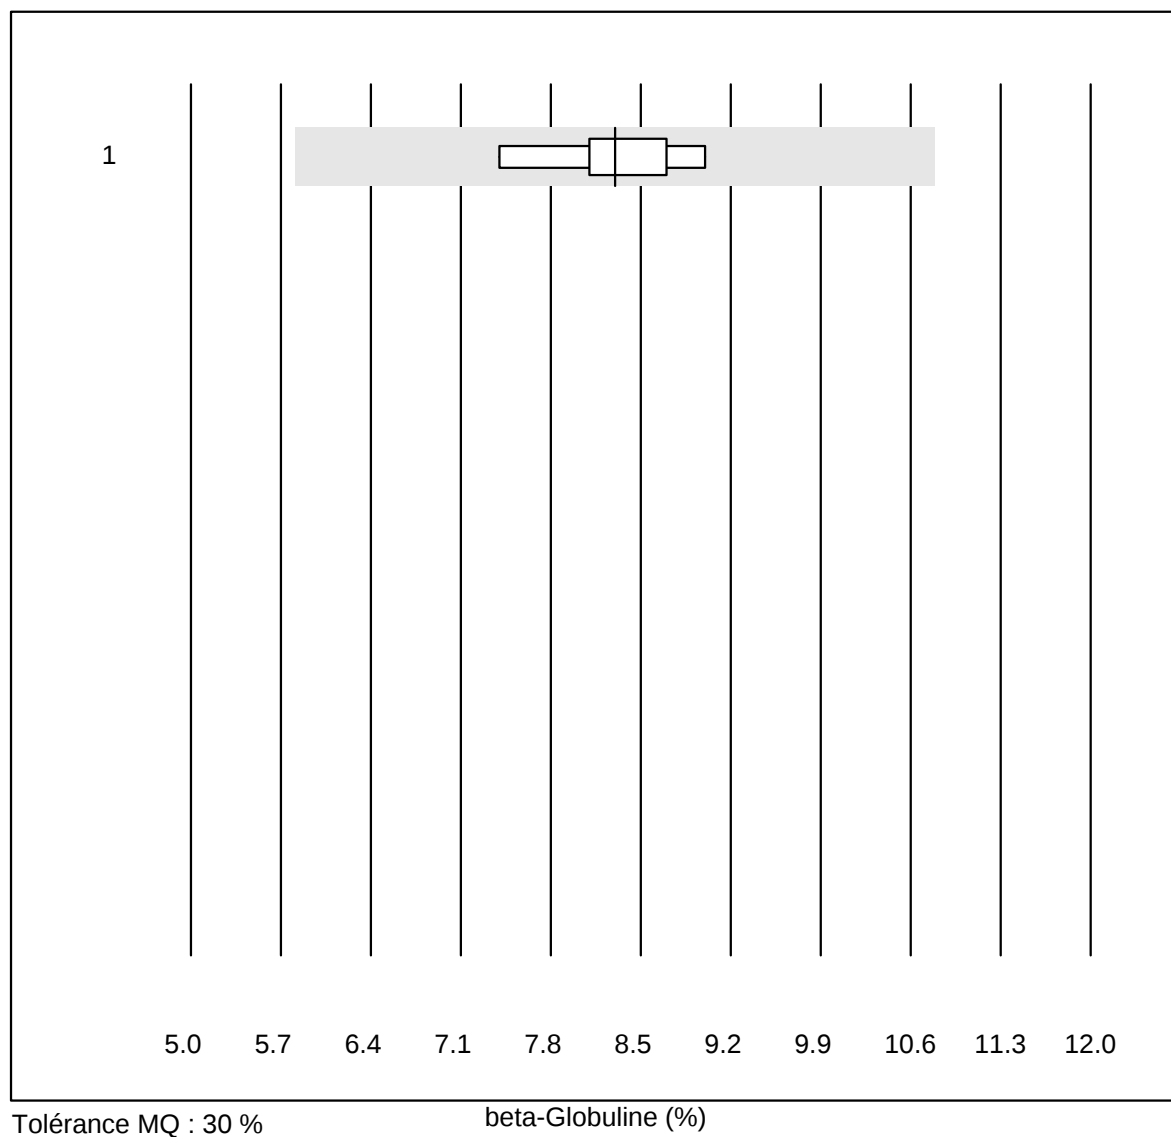beta-Globuline


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 électrophorèse	9	100.0	0.0	0.0	8.3	5.8	e

Beta-1-Globulin

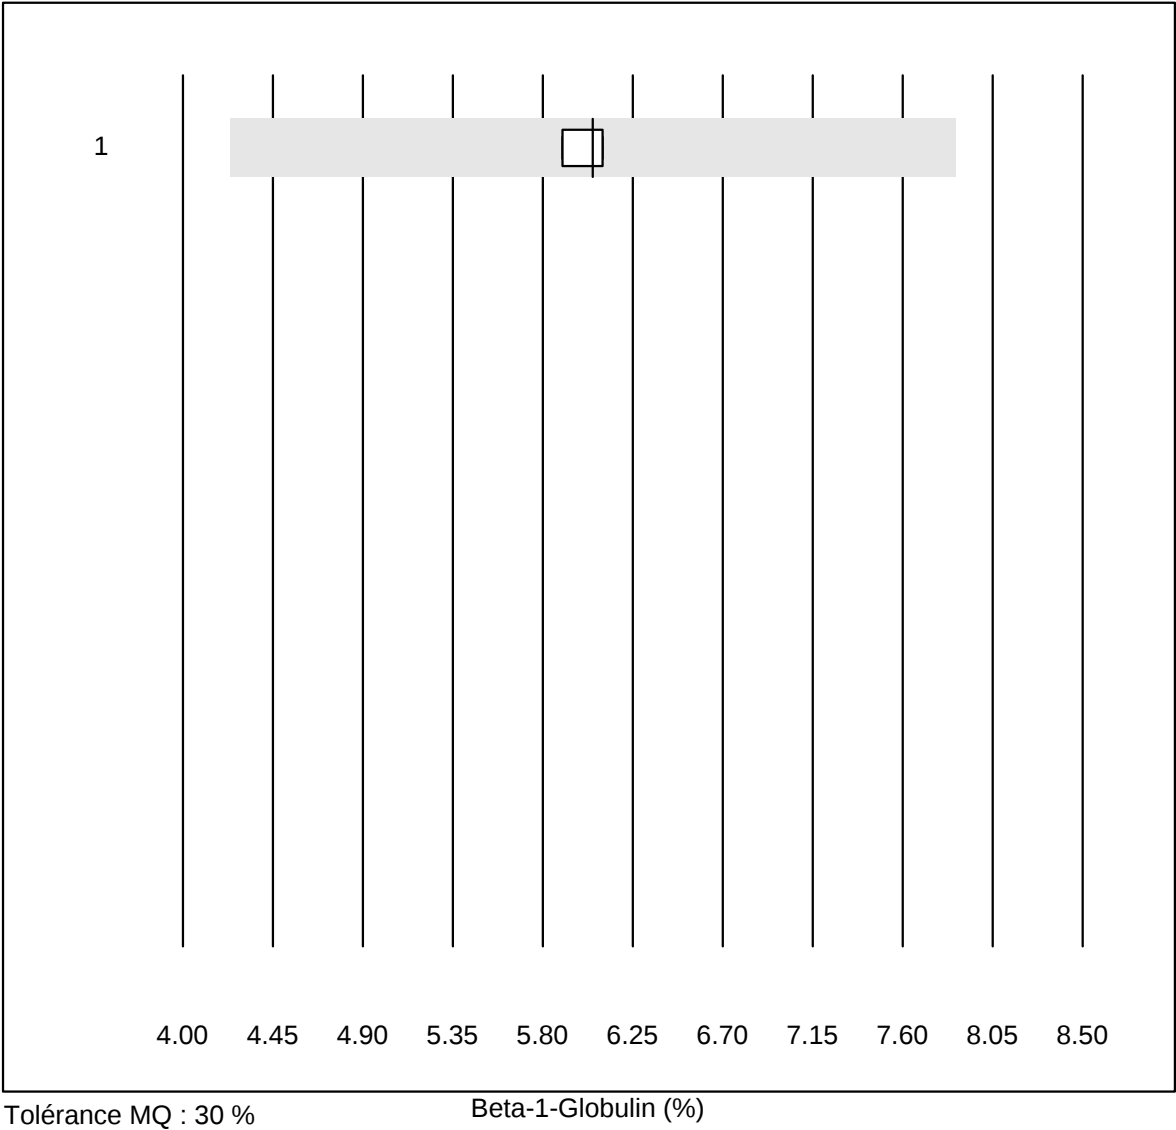


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 électrophorèse	4	100.0	0.0	0.0	6.1	1.6	e

Beta-2-Globulin

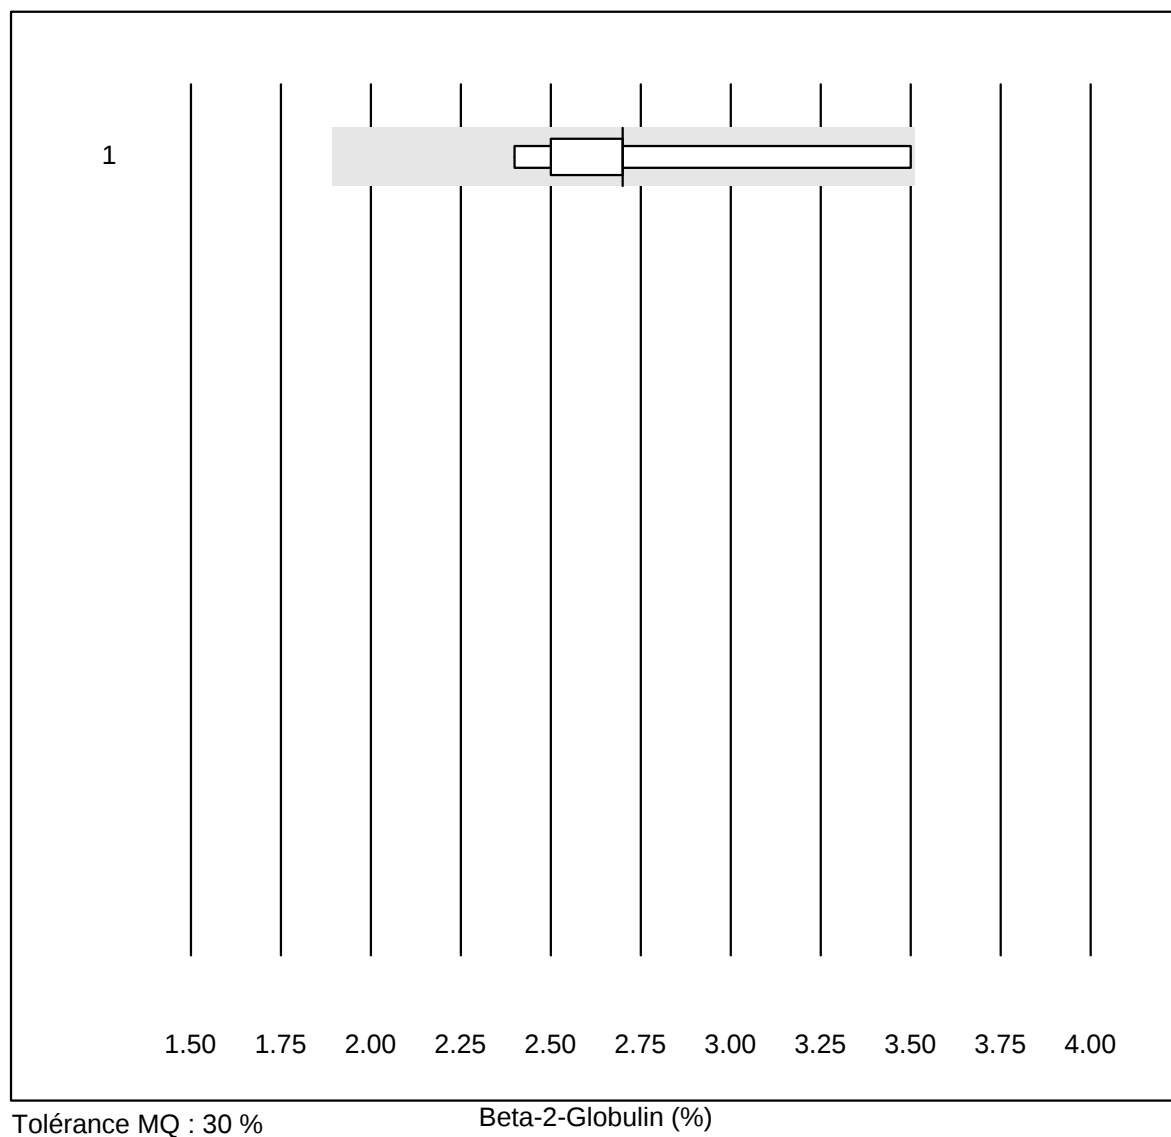


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 électrophorèse	5	100.0	0.0	0.0	2.7	15.7	e*

gamma-Globuline

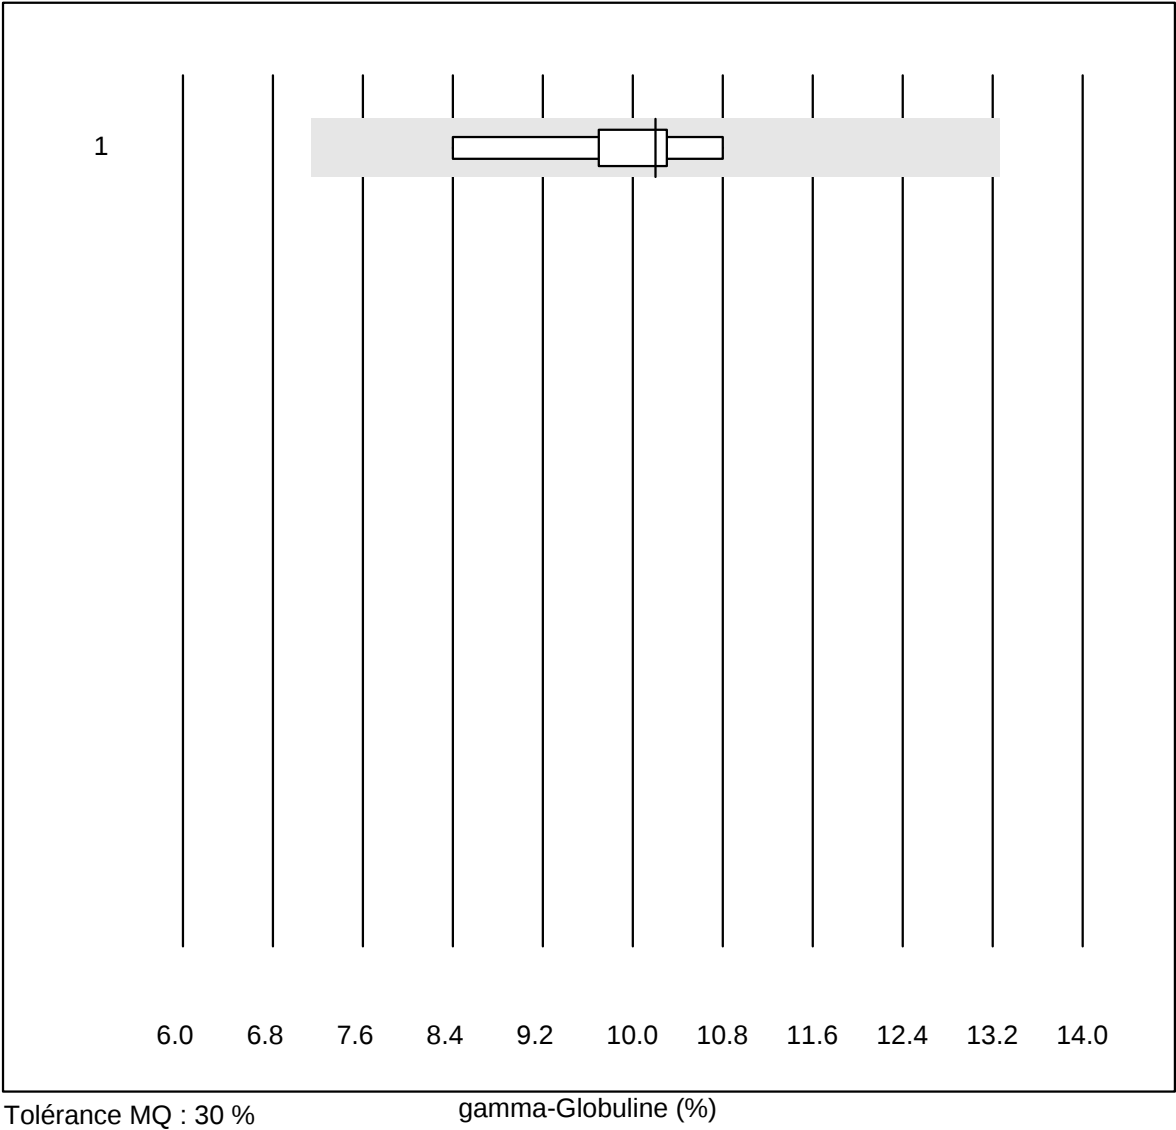


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 électrophorèse	8	100.0	0.0	0.0	10.2	7.3	e

Paraprotein

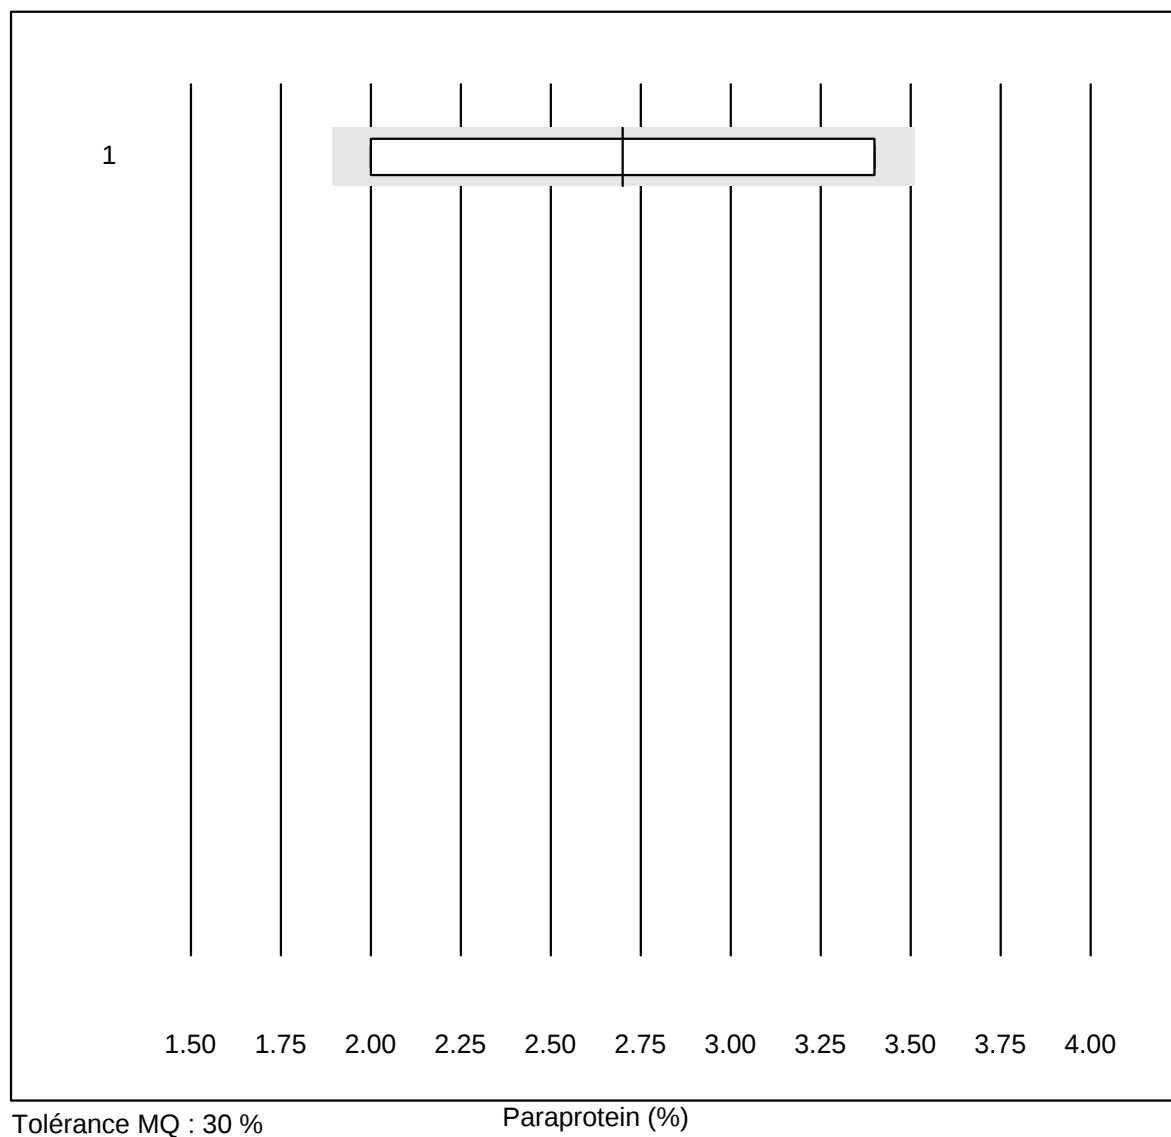

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 électrophorèse	4	75.0	0.0	25.0	2.7	32.8	e*

Immunfixation

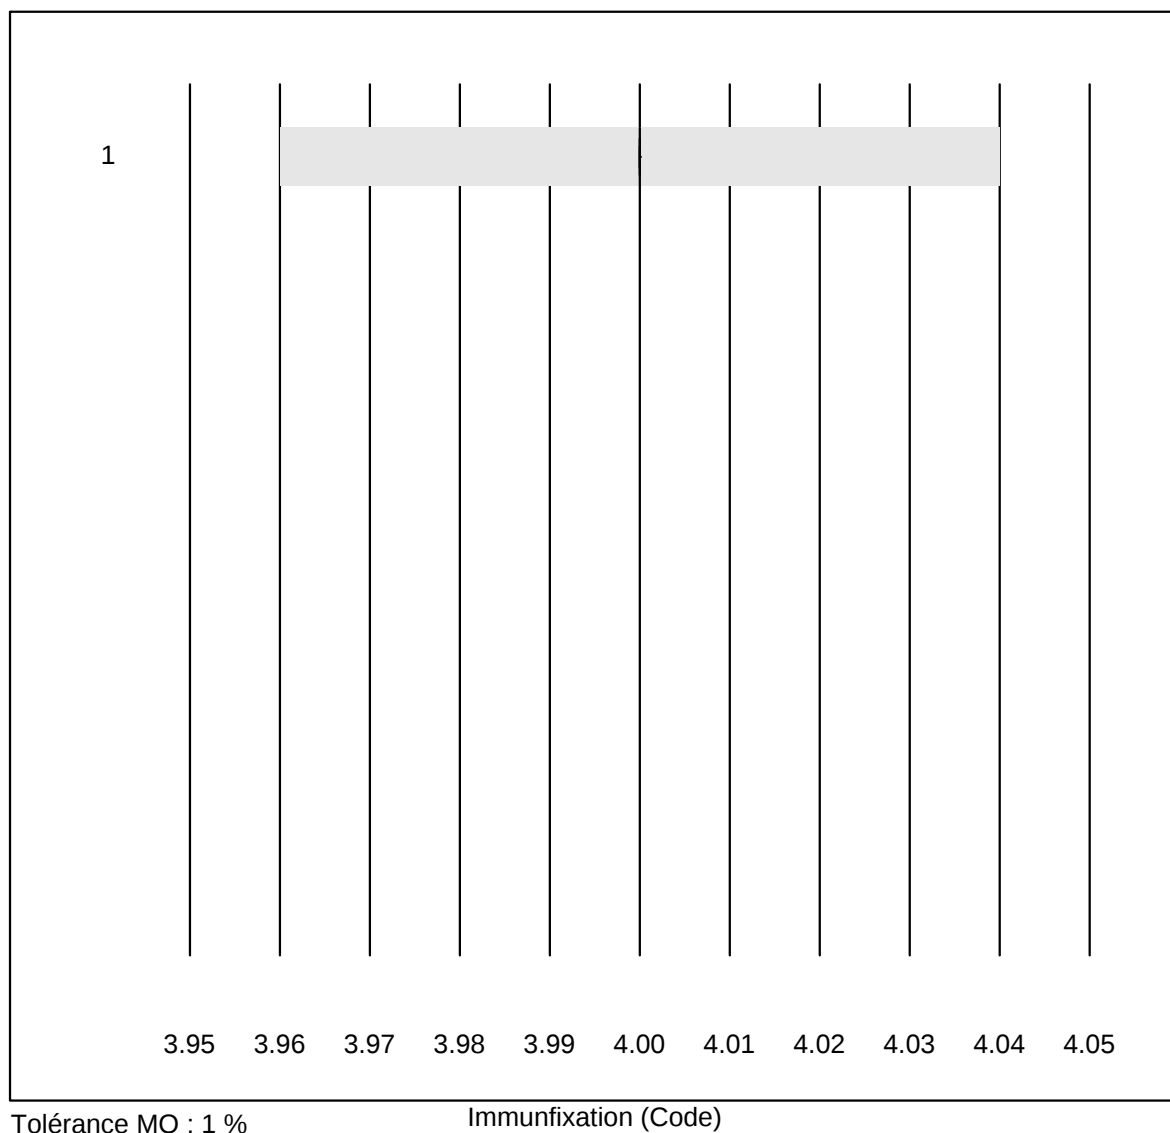


Tolérance MQ : 1 %

Immunfixation (Code)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	interprétation	8	100.0	0.0	0.0	4	0.0	e

Folates érythrocytaires

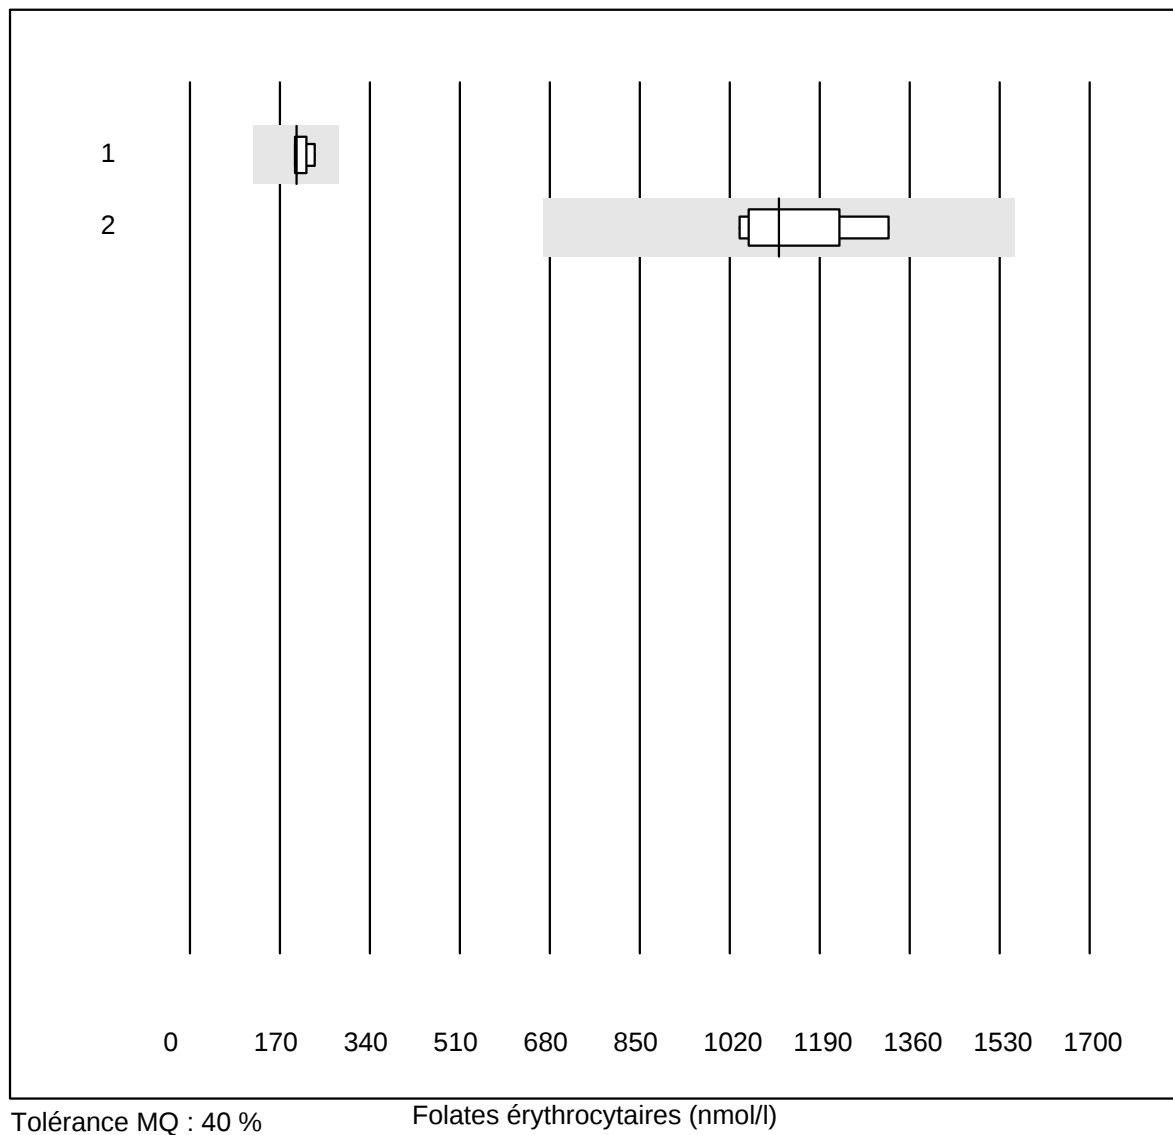


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Architect	7	85.7	0.0	14.3	201	7.6	e
2	Cobas	8	100.0	0.0	0.0	1112	9.6	e

Gallensäure

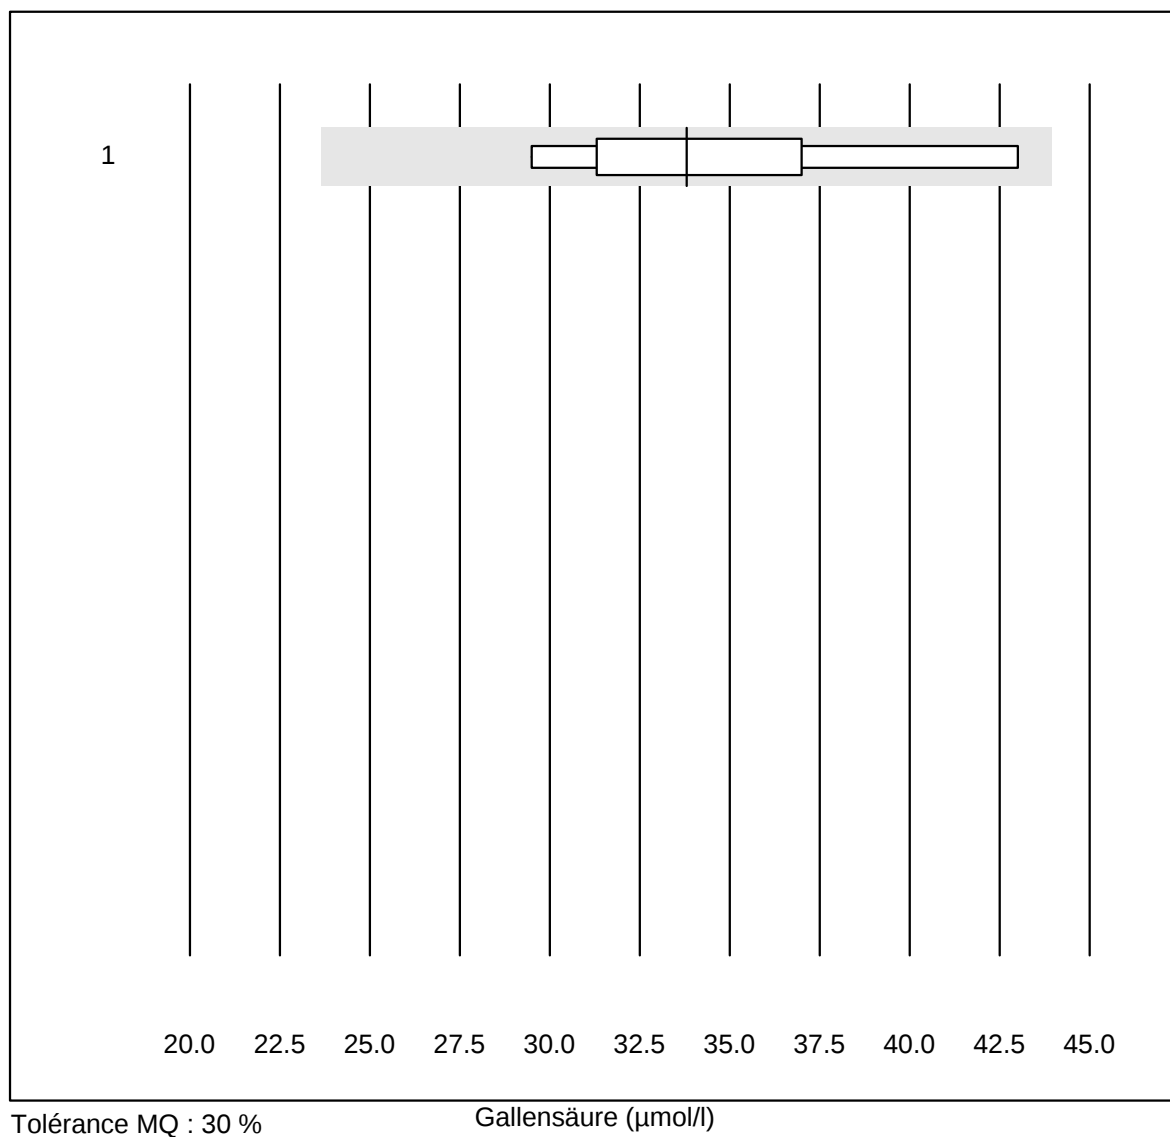

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	9	100.0	0.0	0.0	33.8	12.7	e*

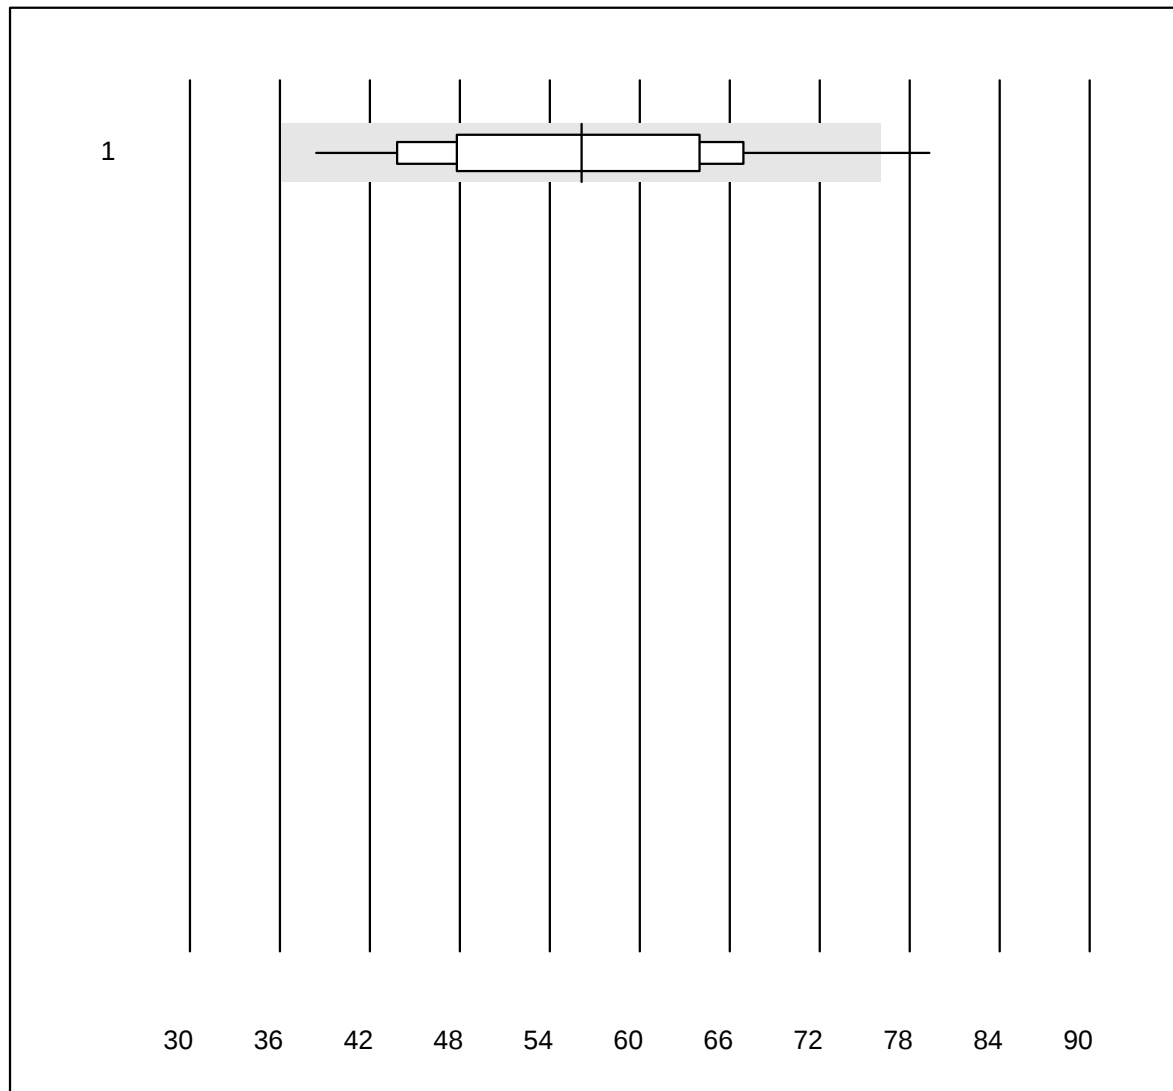
BNP

QUALAB Toleranz : 27 %
 (< 75.0: +/- 20.0 ng/l)

BNP (ng/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Triage	19	94.7	5.3	0.0	56.1	18.2	e*

Troponin Triage

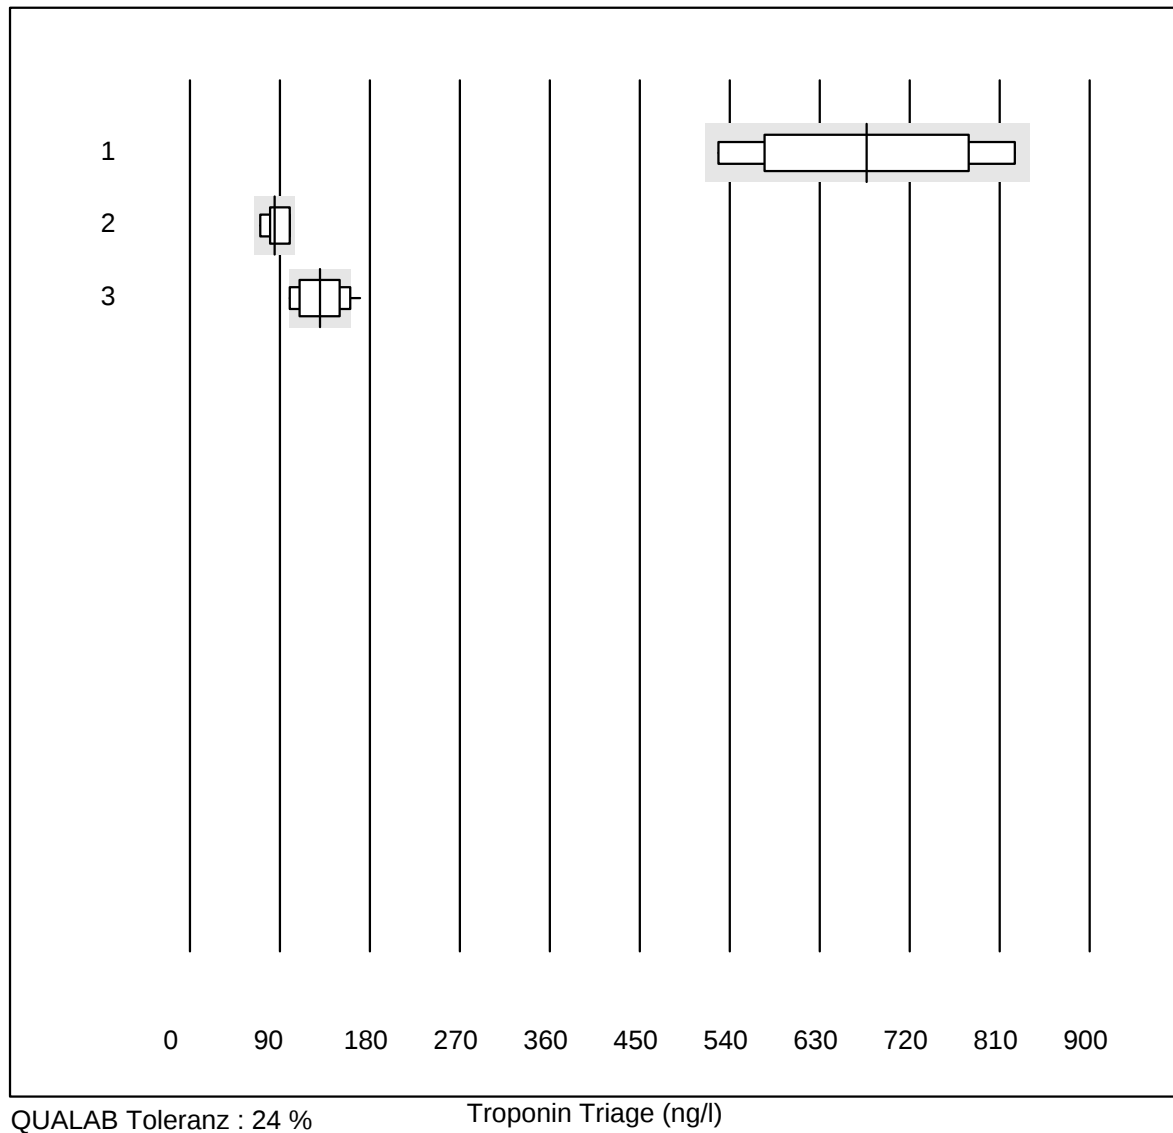


QUALAB Toleranz : 24 %

Troponin Triage (ng/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Triage high sensitiv	5	100.0	0.0	0.0	677.25	19.3	a
2	Triage SOB/Cardiac	8	87.5	0.0	12.5	85.00	12.8	e*
3	Triage Next Gen	19	78.9	5.3	15.8	130.00	18.1	e*

NT-pro BNP

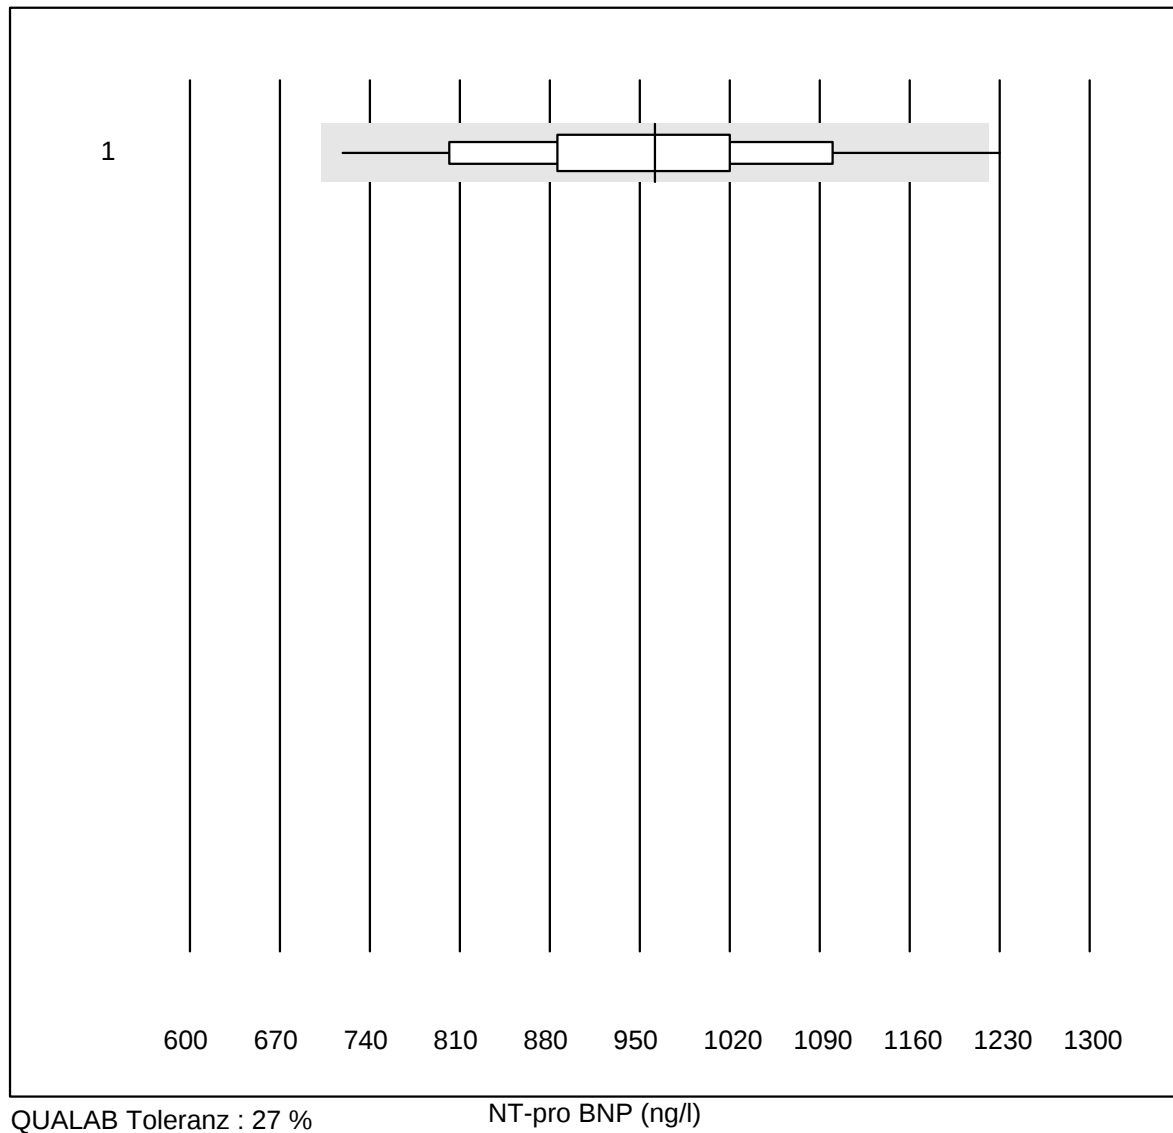


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Triage	12	83.4	8.3	8.3	962	14.3	e*

D-Dimere Triage

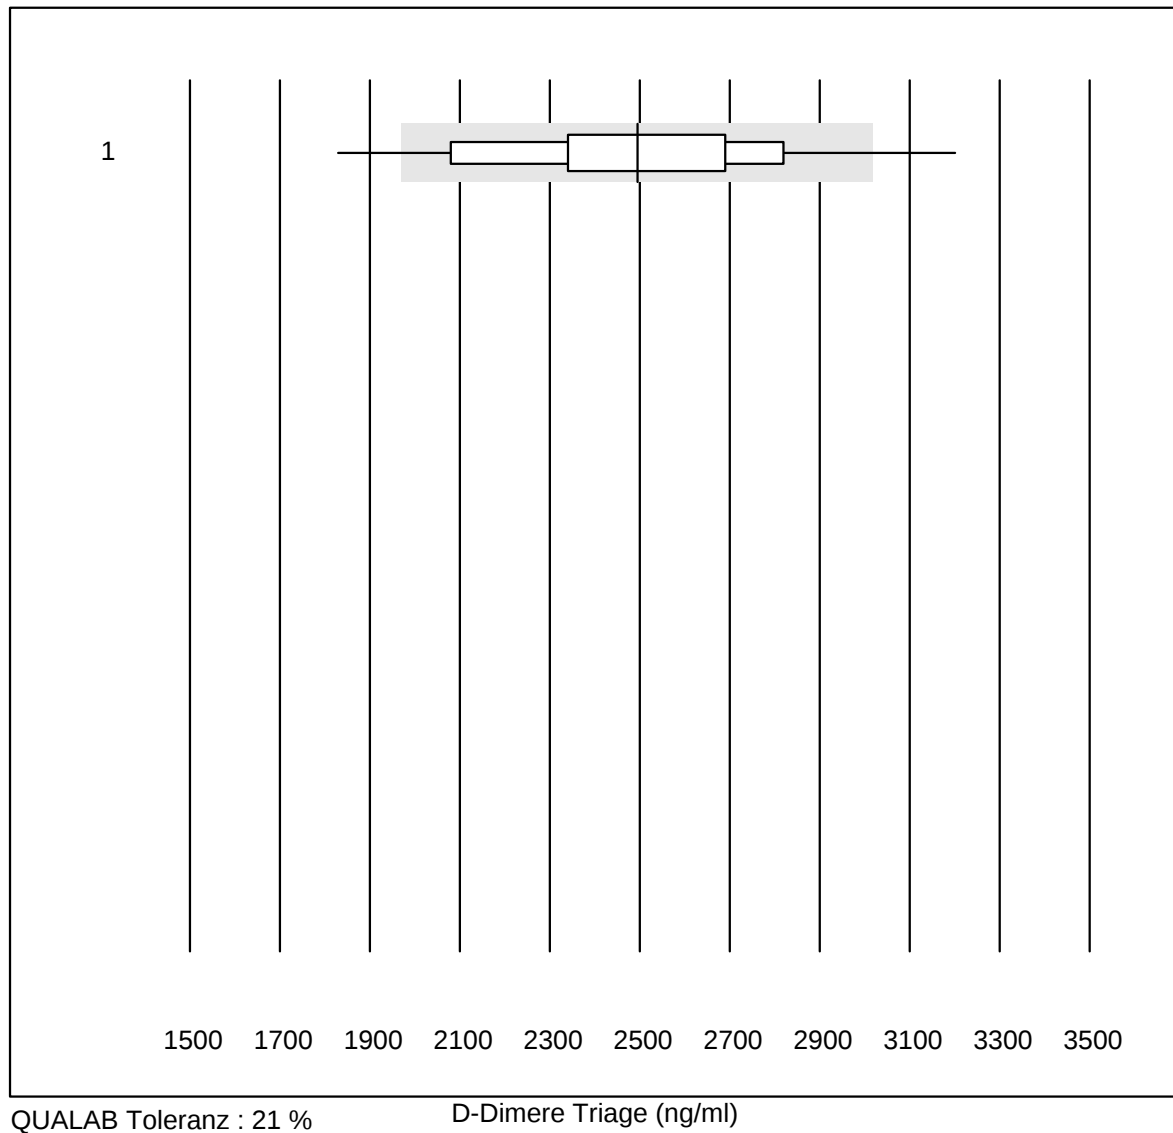


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Triage	32	90.6	9.4	0.0	2494.22	12.2	e

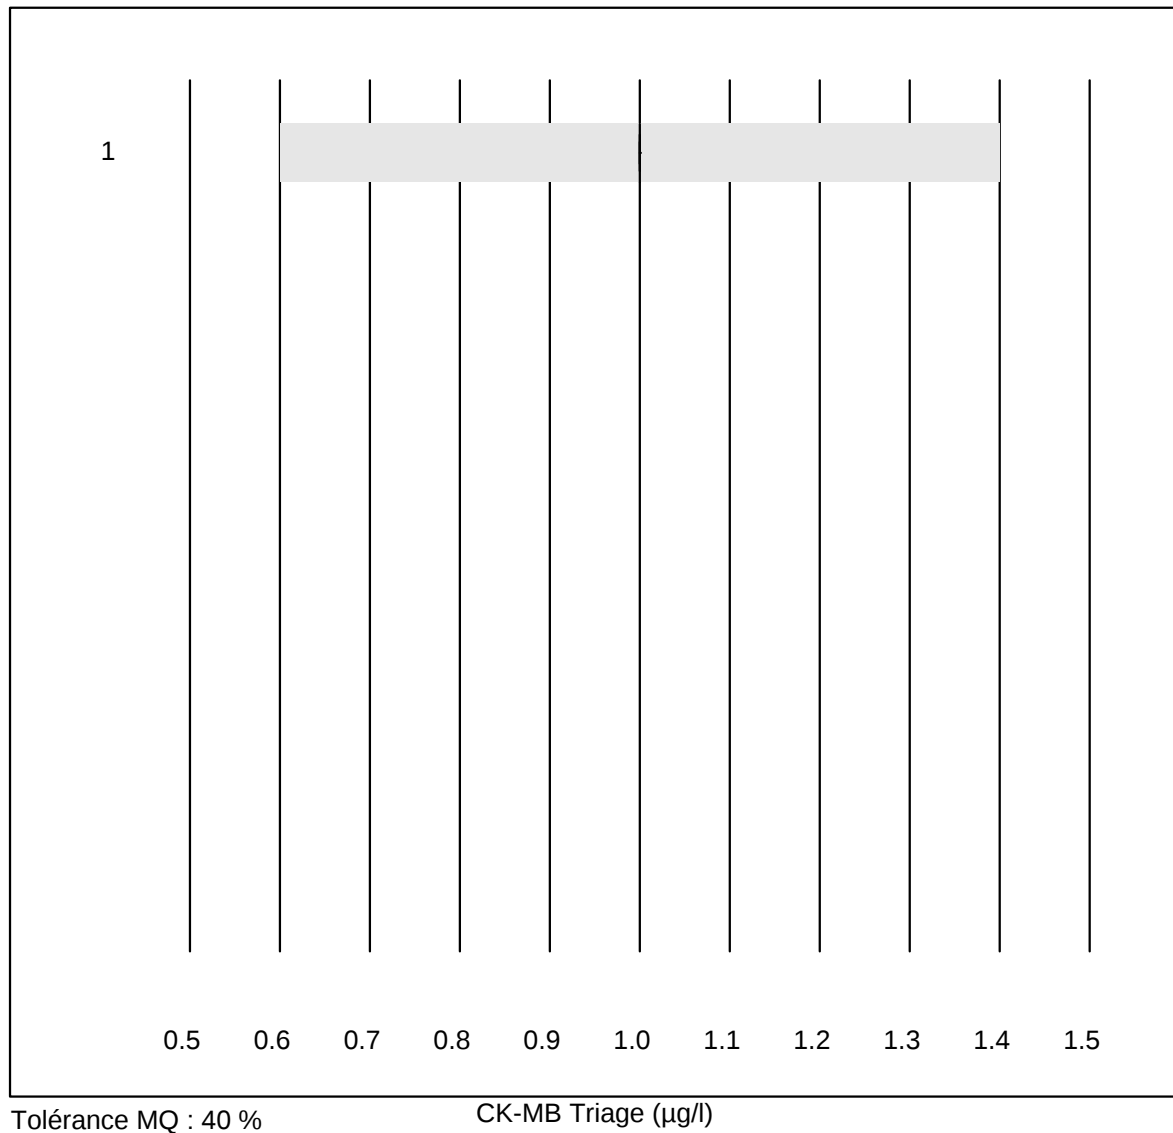CK-MB Triage


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Triage	7	100.0	0.0	0.0	1.0	0.0	e

Myoglobin Triage

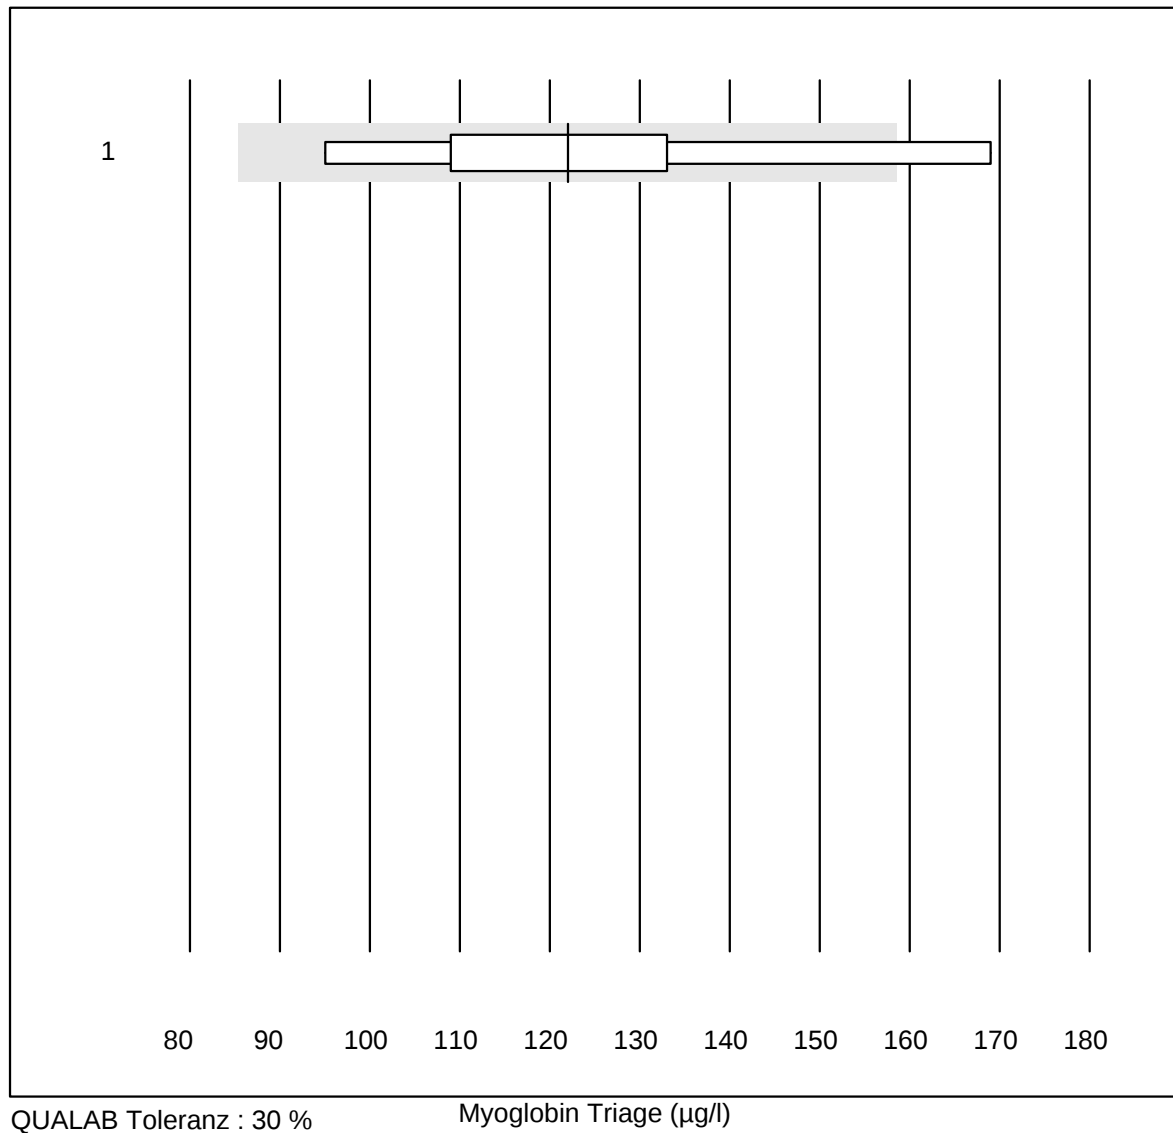


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Triage	7	85.7	14.3	0.0	122.0	19.4	a

Vitamine D 25 (OH)

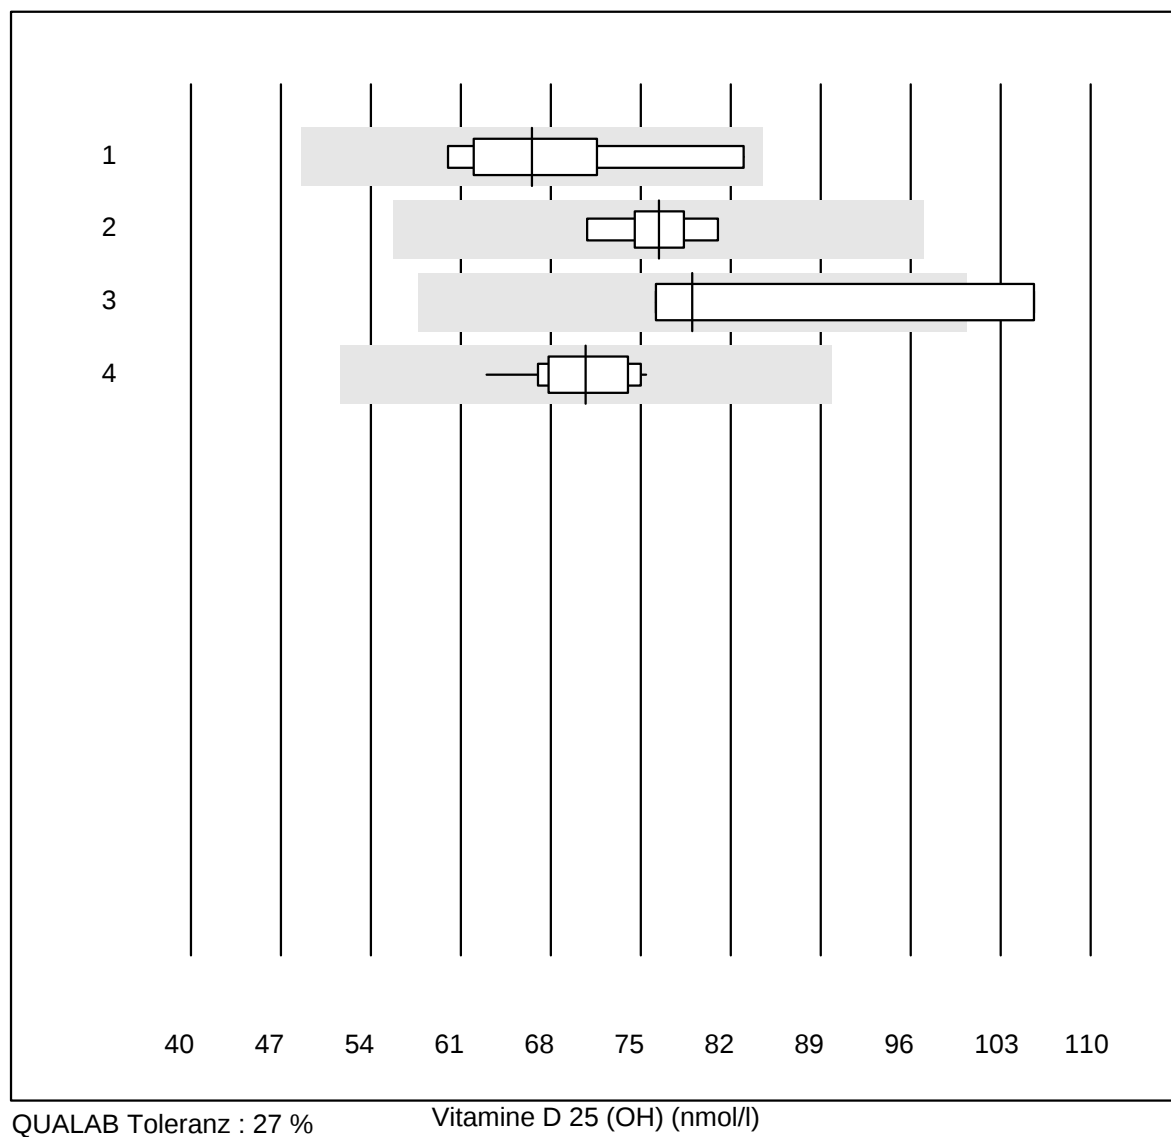


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas	8	100.0	0.0	0.0	66.5	11.4	e*
2	VIDAS	6	100.0	0.0	0.0	76.4	4.6	e
3	Autres méthodes	4	50.0	25.0	25.0	79.0	17.7	a
4	Architect	11	100.0	0.0	0.0	70.7	5.4	e

AMH

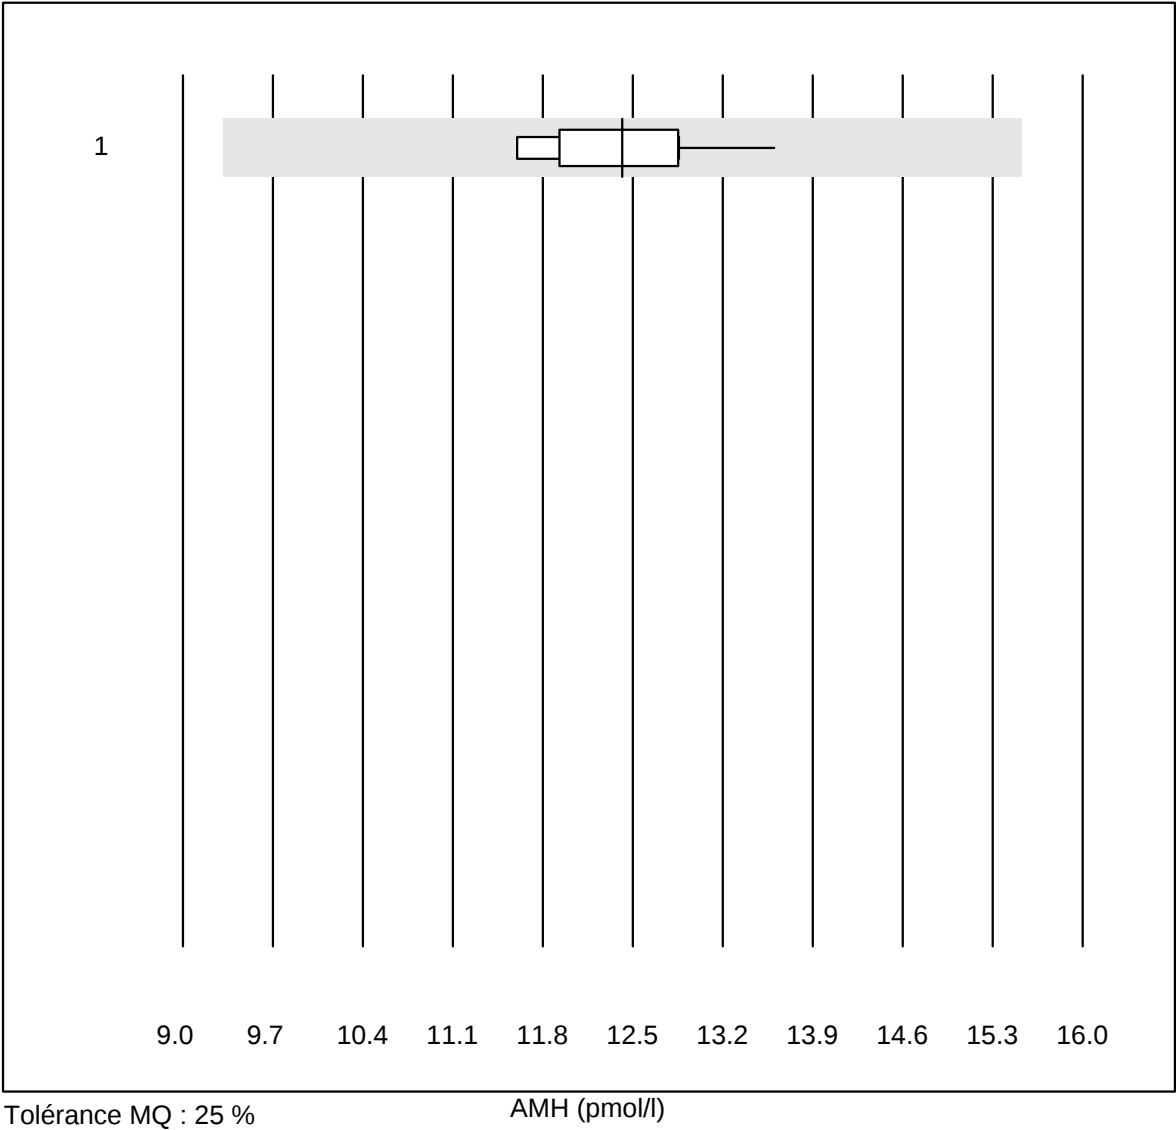


Nr. Methode		Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	10	100.0	0.0	0.0	12.4	5.0	e

Calcitonin

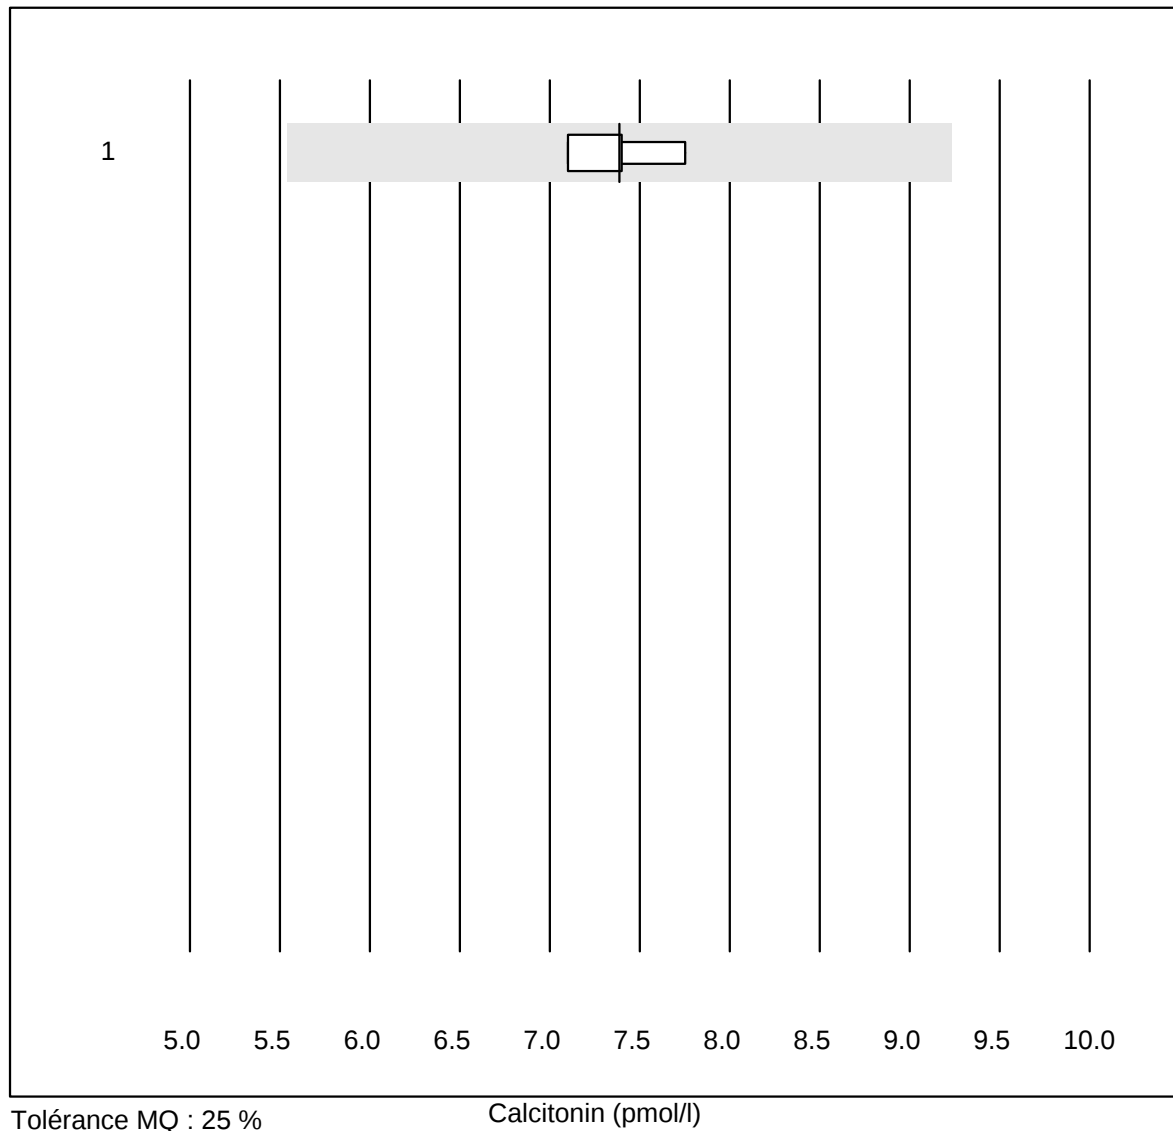


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	7.4	3.6	e

IGF-BP3

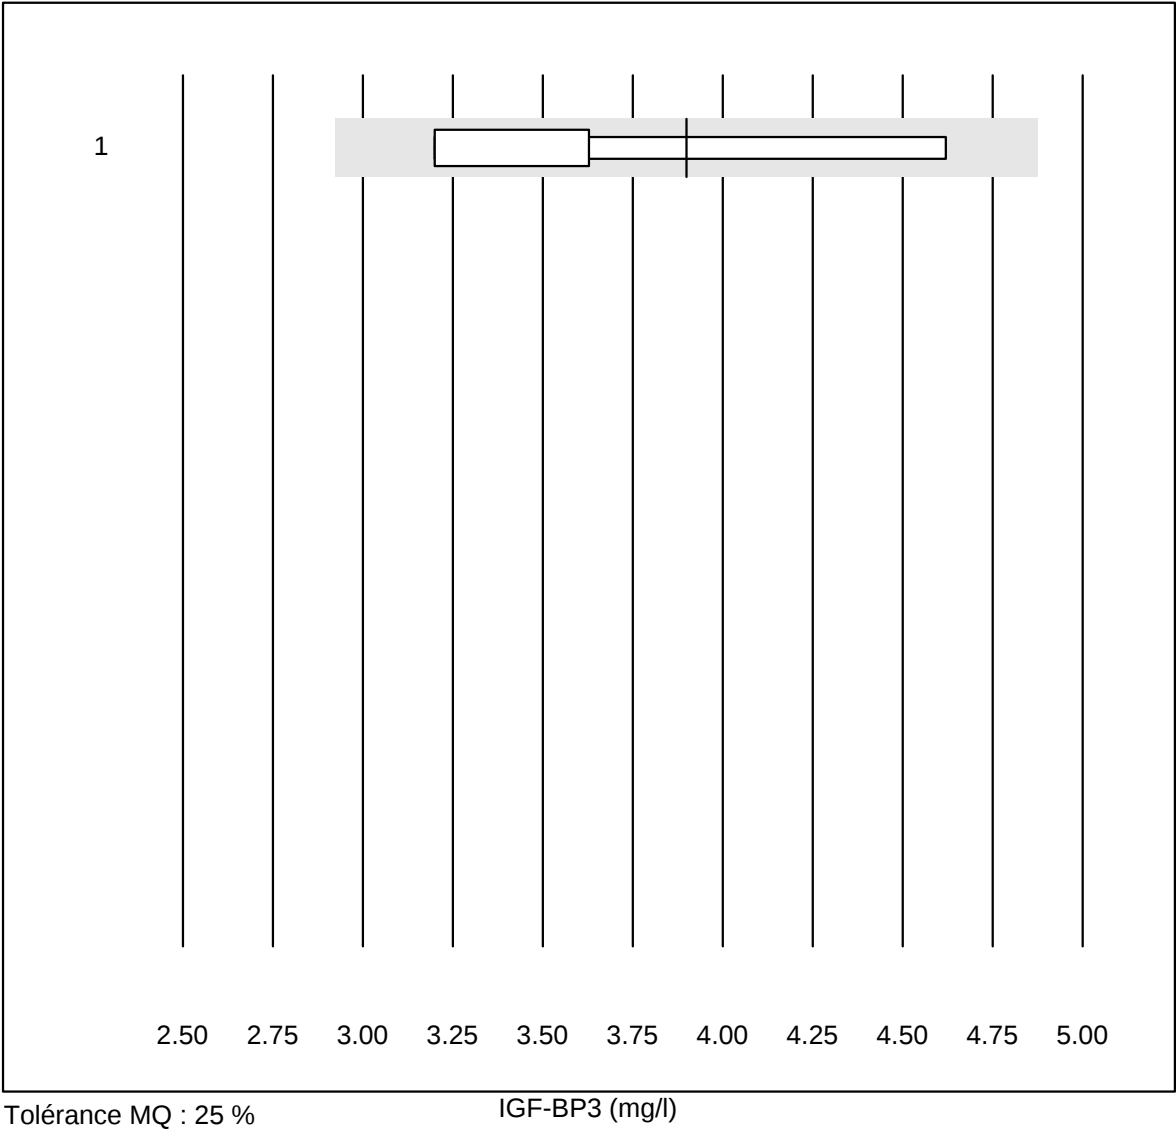


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	3.90	16.9	a

Anti Thyreoglobulin

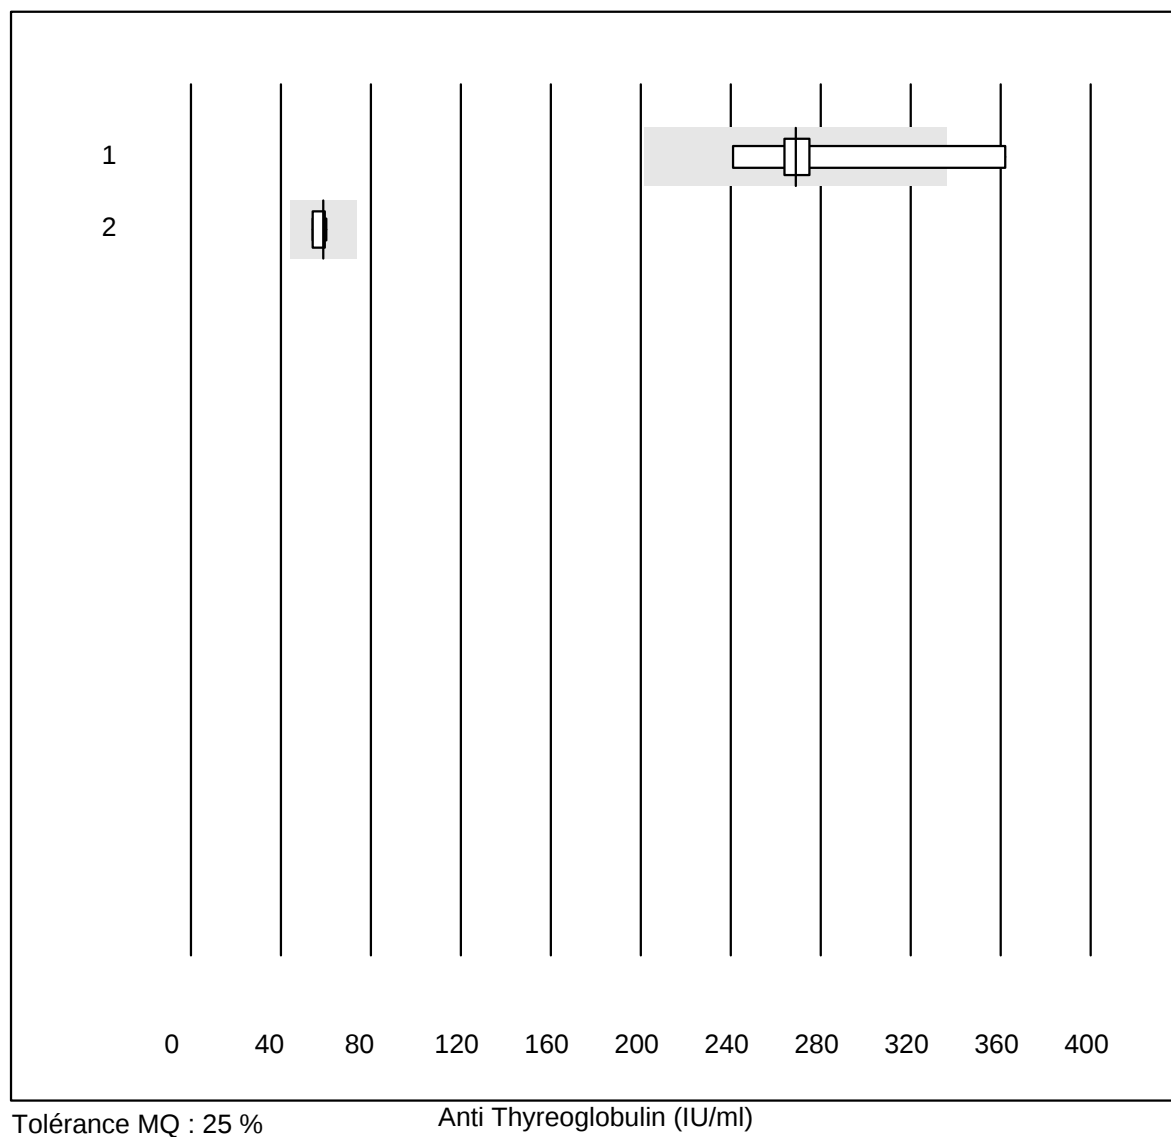


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas	8	87.5	12.5	0.0	269	12.8	e*
2	Architect	4	100.0	0.0	0.0	59	4.6	e

Anti TPO

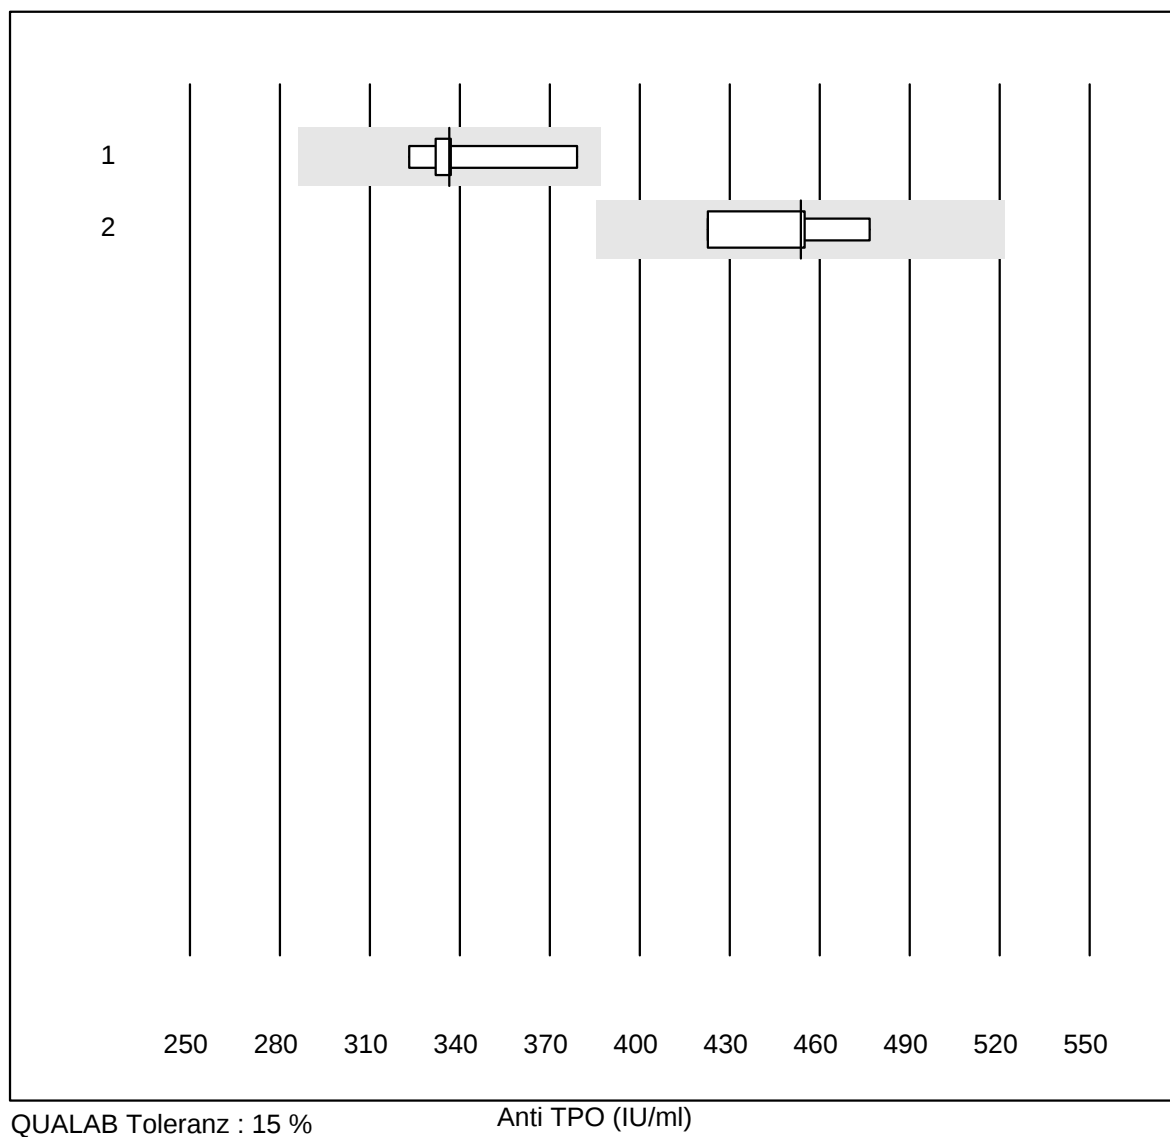


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas	6	83.3	0.0	16.7	337	6.4	e*
2	Architect	4	100.0	0.0	0.0	454	4.9	e*

TRAK

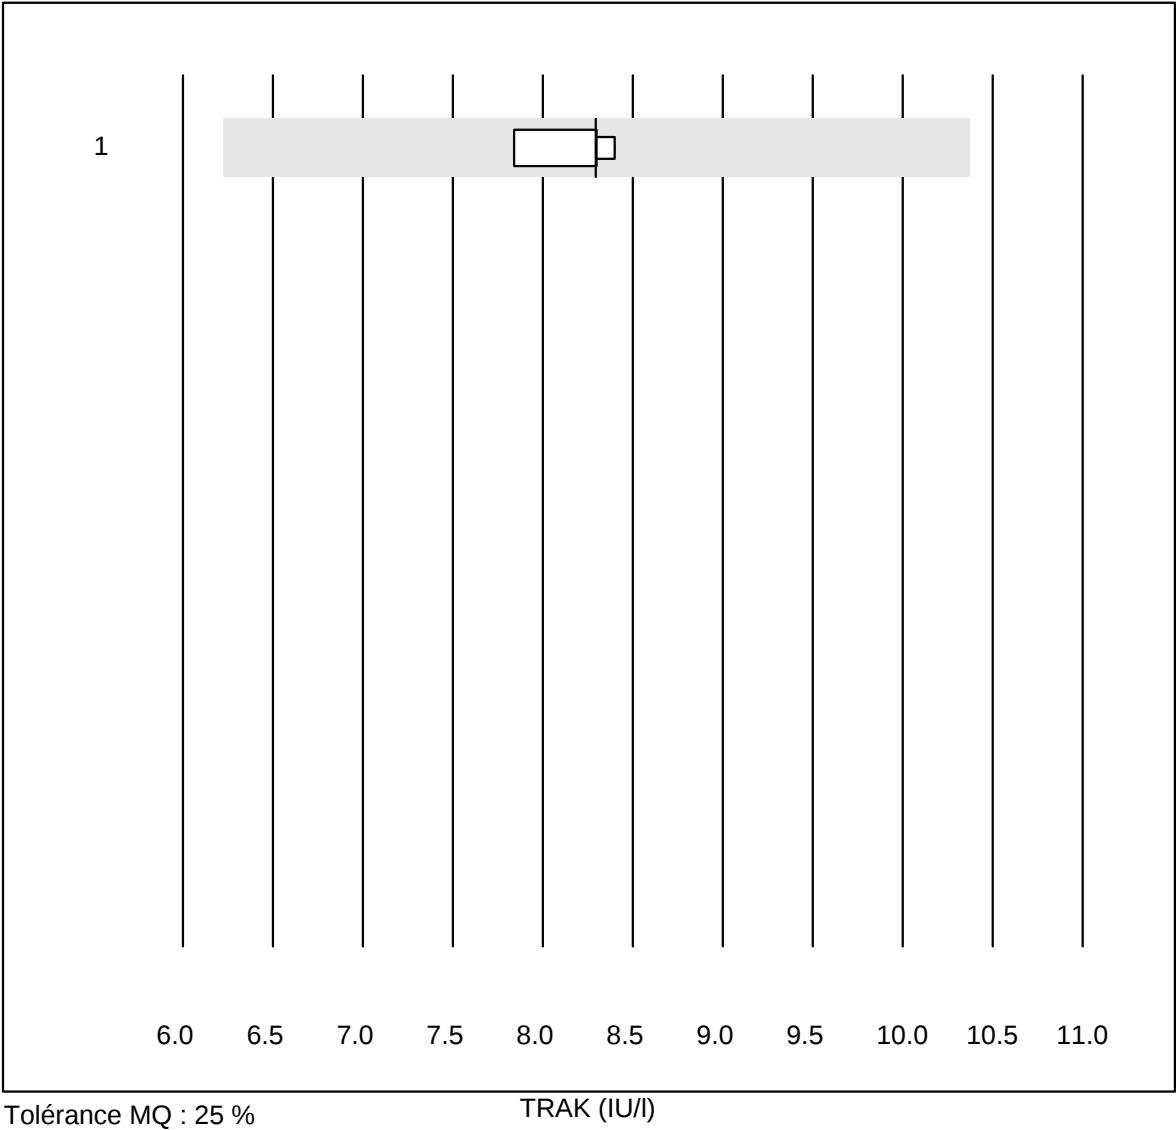


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Kryptor	4	100.0	0.0	0.0	8.30	3.0	e

Créatinine WB

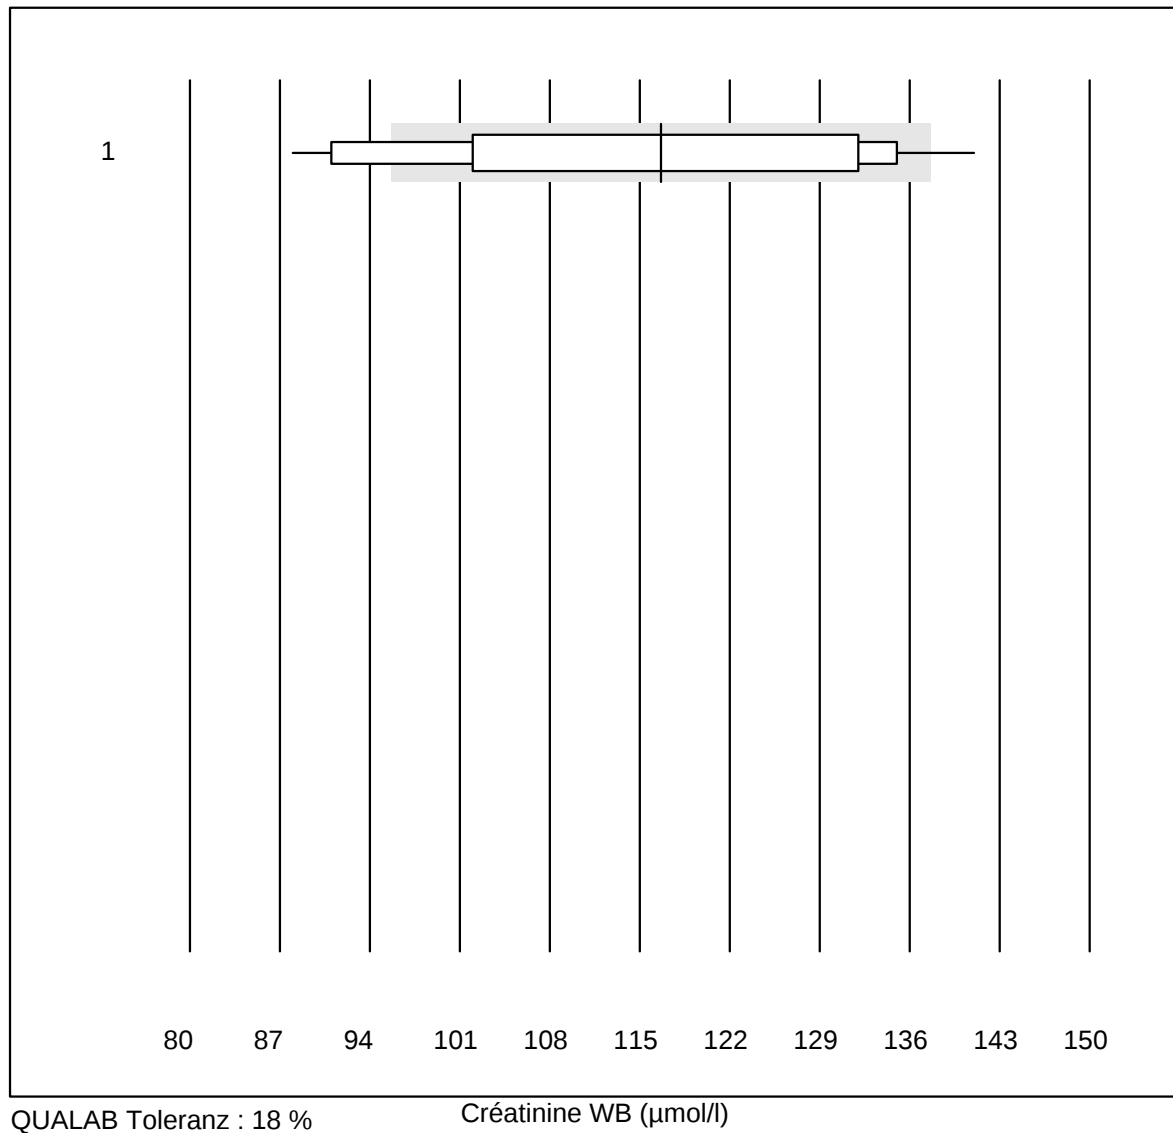


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Statsensor i / Nova	42	50.0	16.7	33.3	117	14.3	e*

Calcium-urine

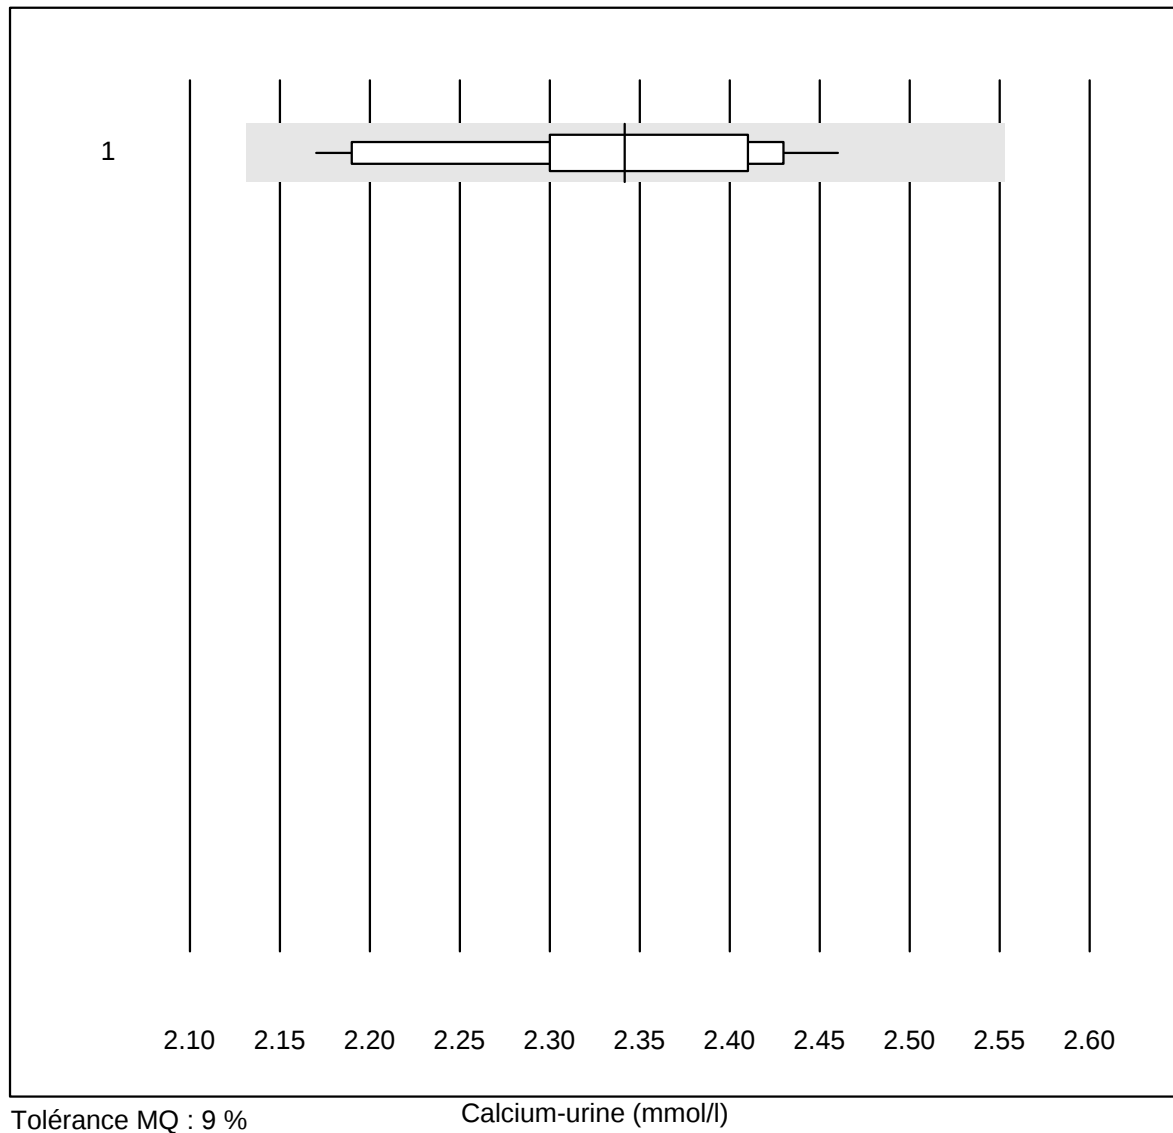


Nr.	Methode	Total	% E fulfil	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	18	100.0	0.0	0.0	2.34	4.0	e

Chlorures-urine

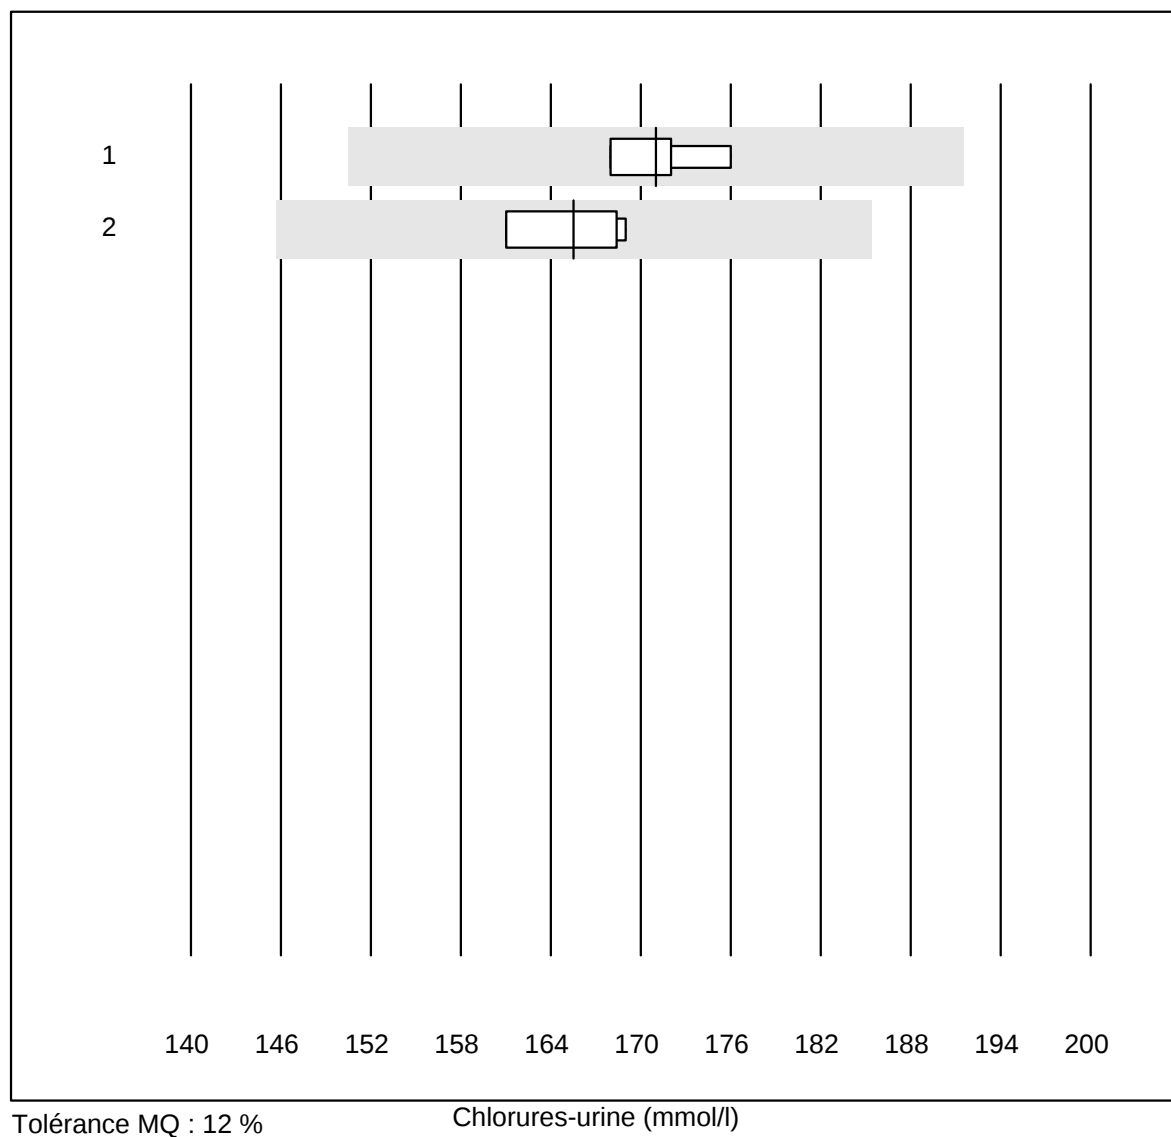


Nr.	Methode	Total	% E fulfil	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	6	100.0	0.0	0.0	171	1.7	e
2	Cobas	6	100.0	0.0	0.0	166	2.2	e

Glucose-urine

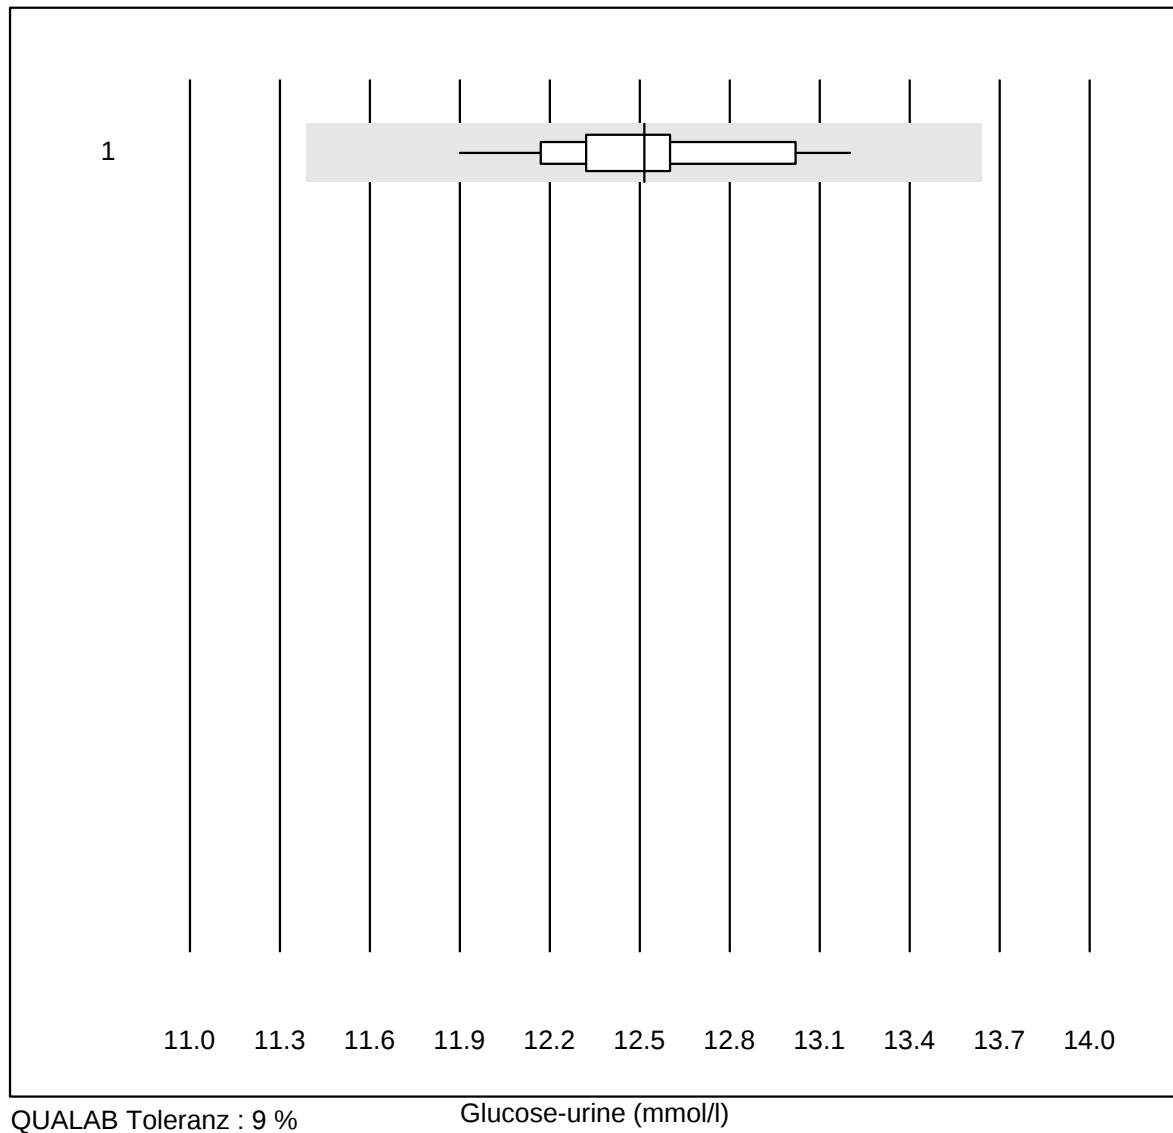

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	17	100.0	0.0	0.0	12.5	2.5	e

Magnésium-urine

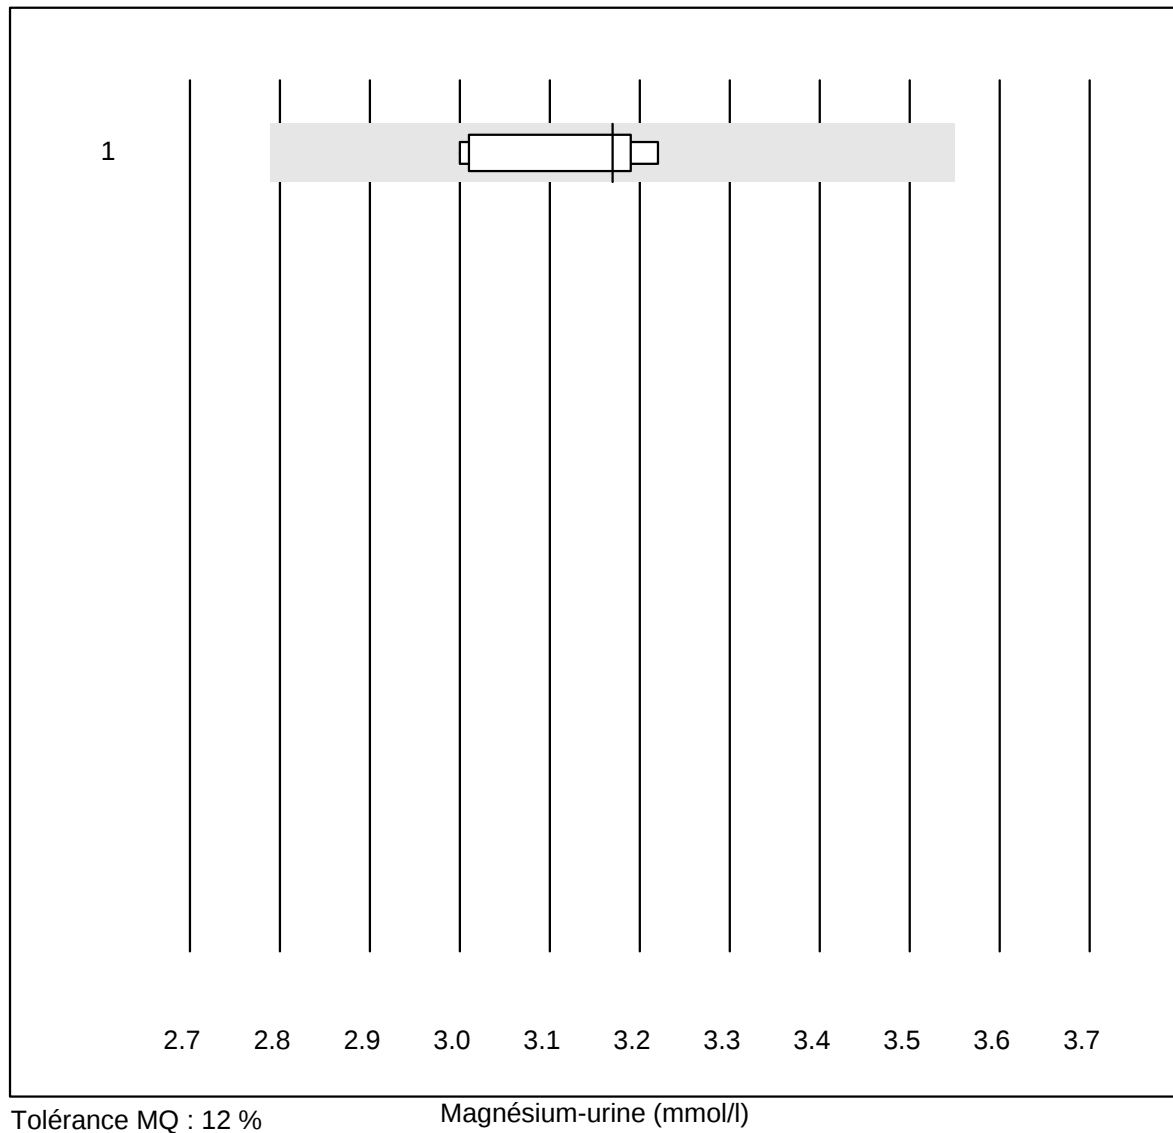


Tolérance MQ : 12 %

Magnésium-urine (mmol/l)


Nr.	Methode	Total	% E fulfil	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	8	100.0	0.0	0.0	3.17	3.0	e

Osmolalité-urine

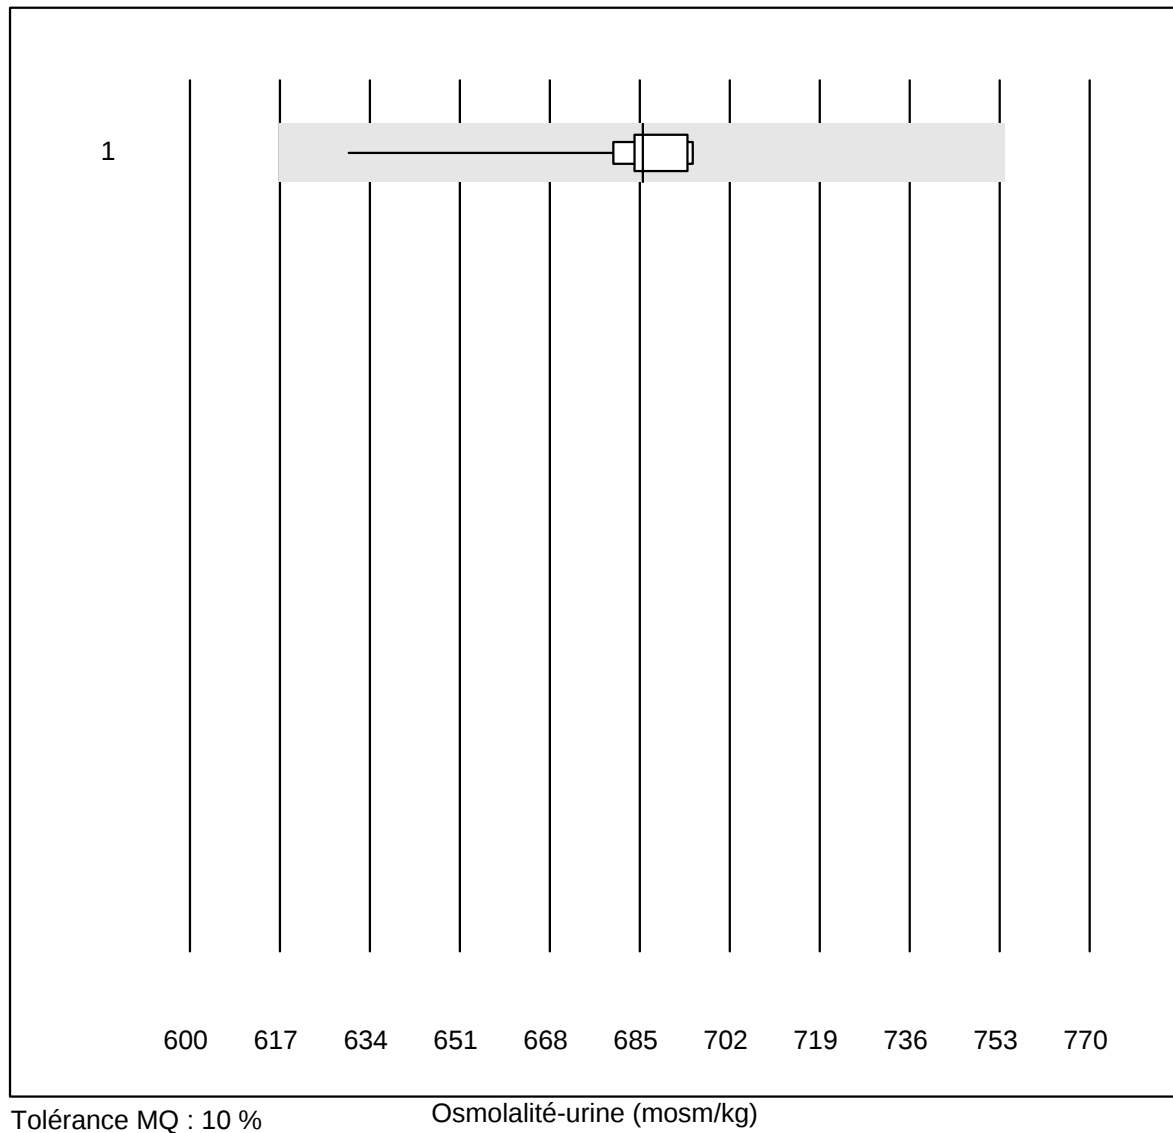


Nr. Methode	Total	% E fulfil t	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cryoscopie	14	100.0	0.0	0.0	686	2.4	e

Phosphore-urine

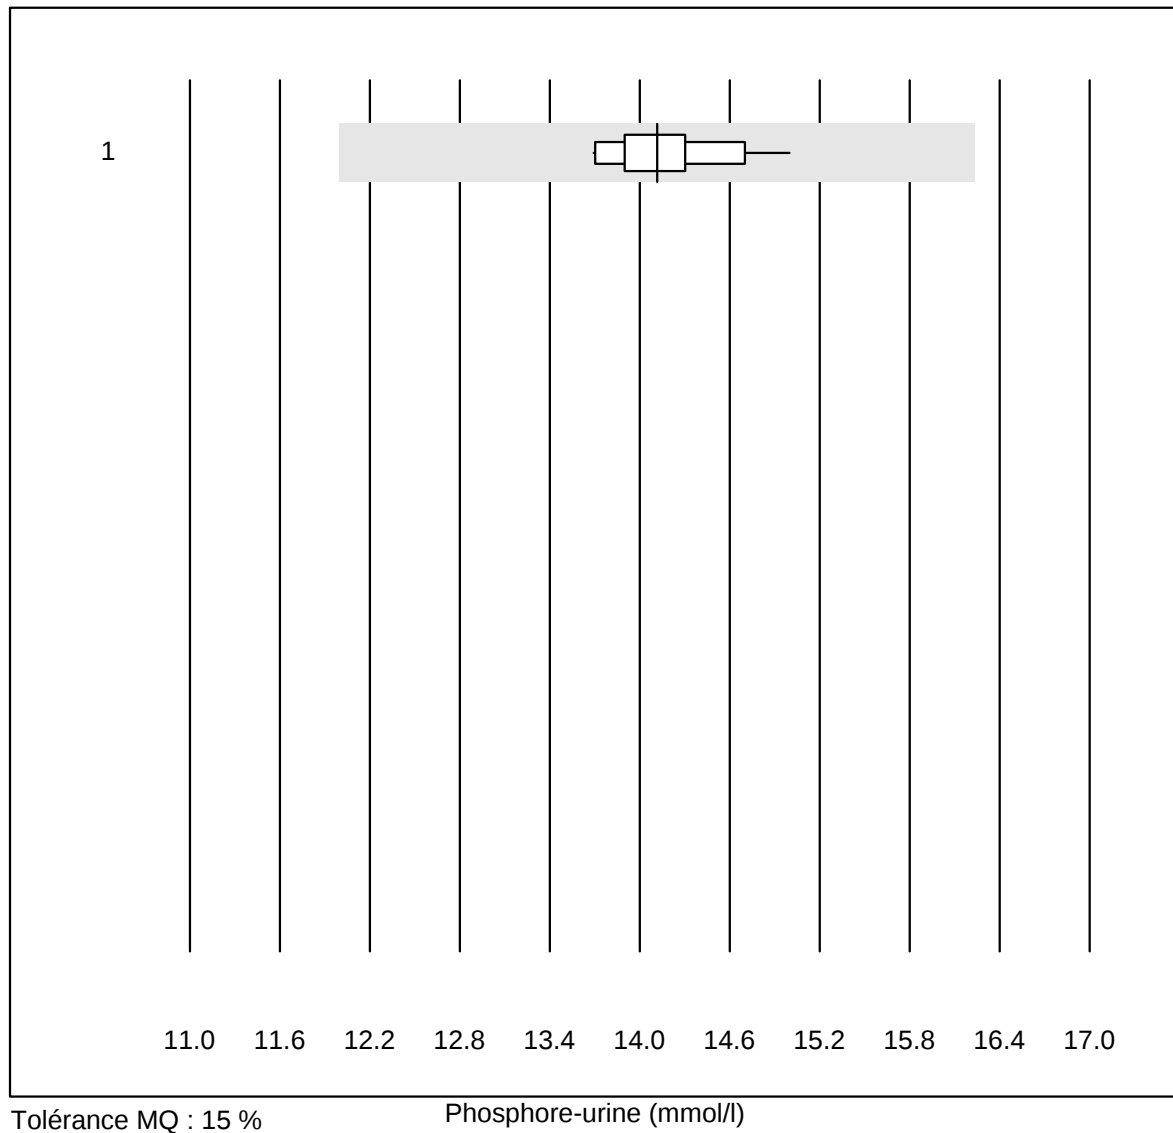


Nr.	Methode	Total	% E fulfil	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	16	100.0	0.0	0.0	14.1	2.6	e

Potassium-urine

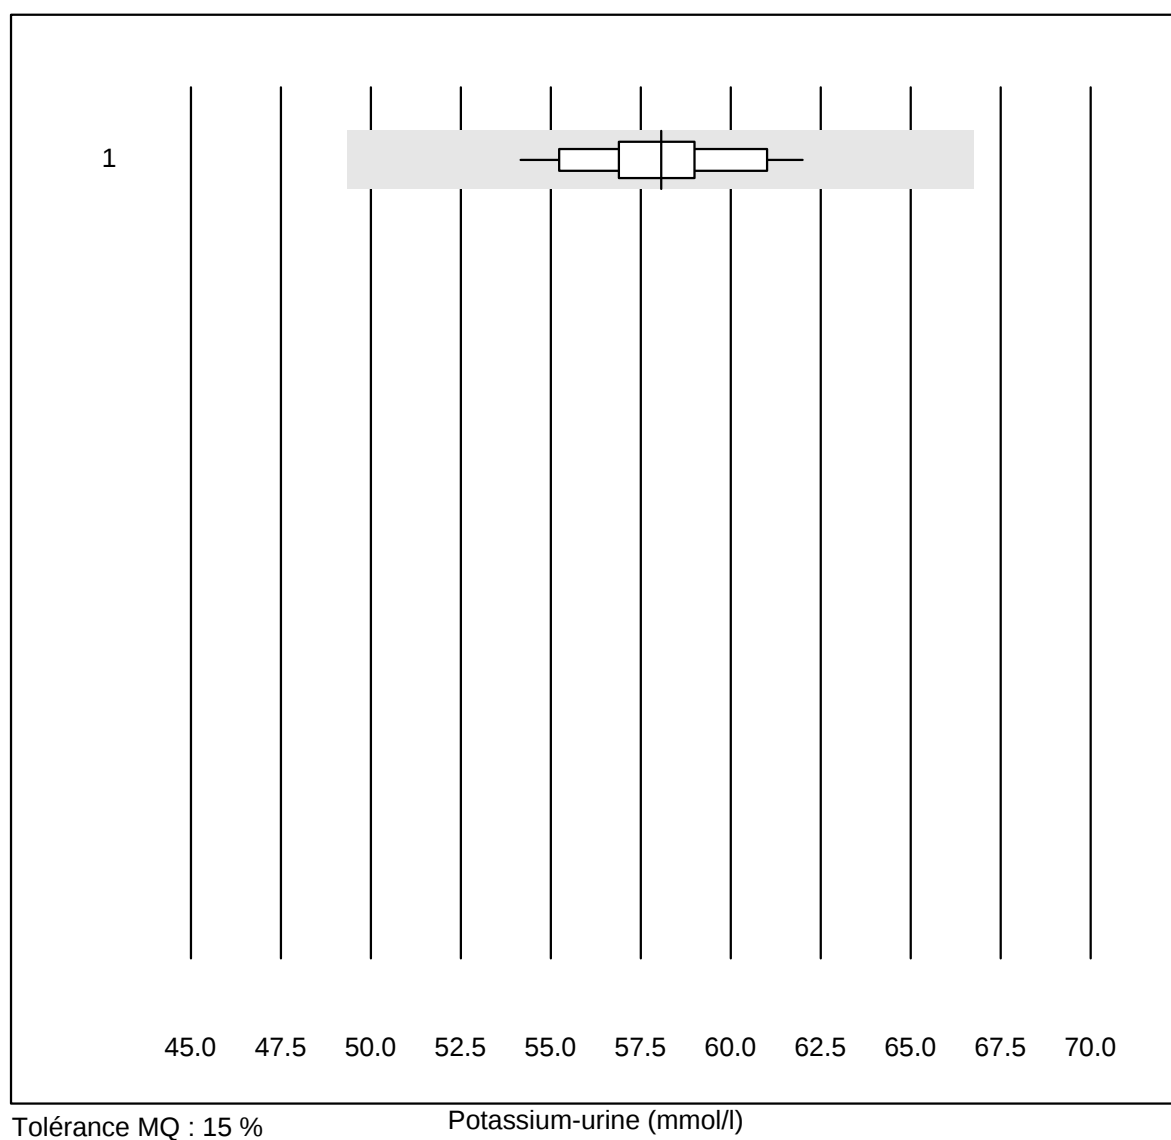

Nr. Methode	Total	% E fulfil	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	25	100.0	0.0	0.0	58	3.4	e

Protéines-urine

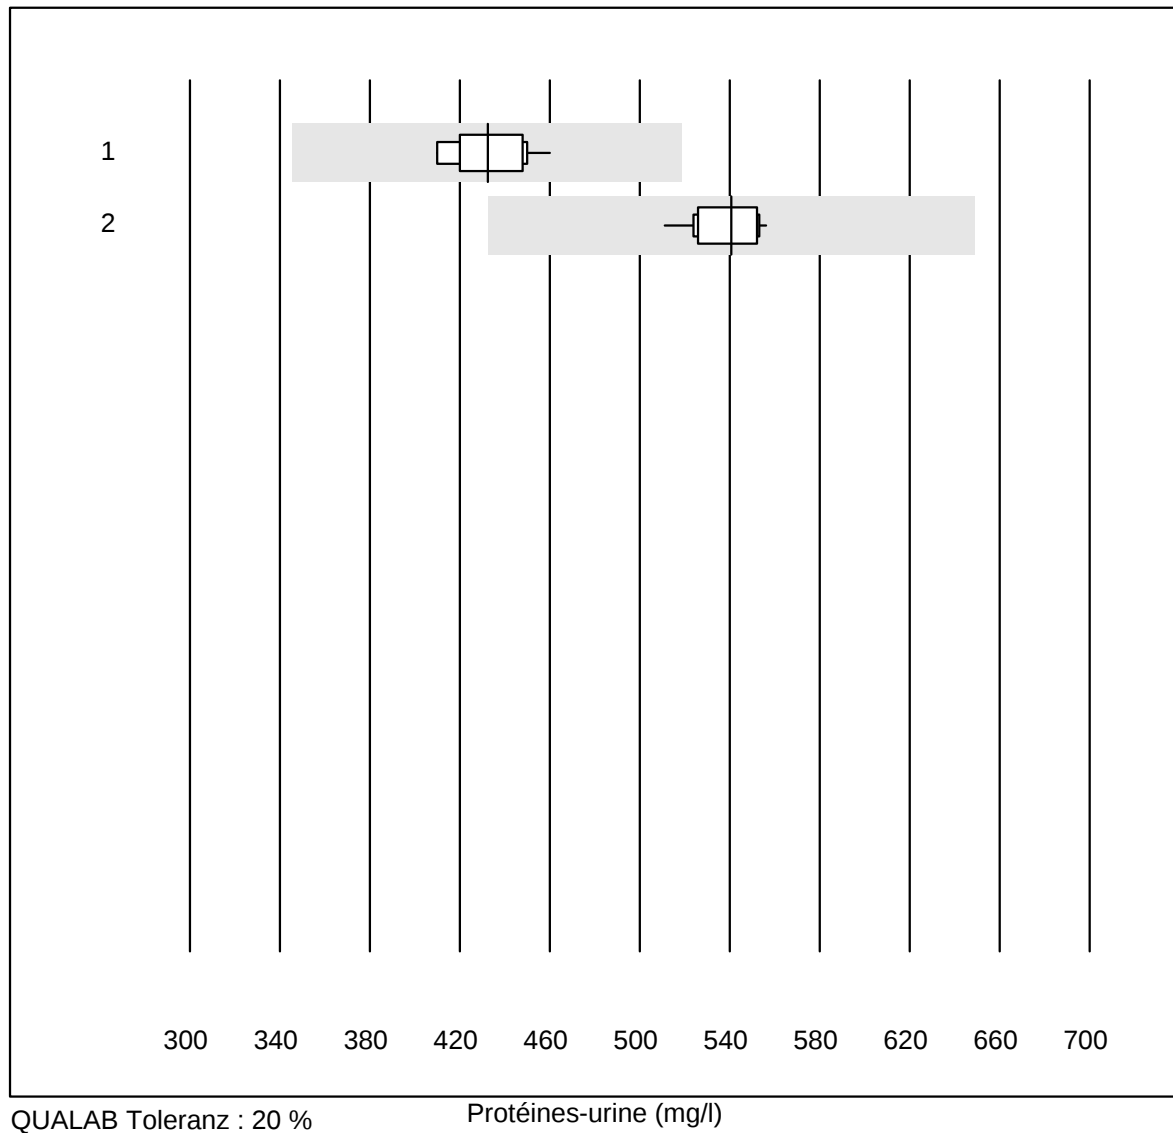


QUALAB Toleranz : 20 %

Protéines-urine (mg/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas/Roche	15	100.0	0.0	0.0	432.3	3.8	e
2	Chimie humide	11	100.0	0.0	0.0	540.6	2.7	e

Sodium-urine

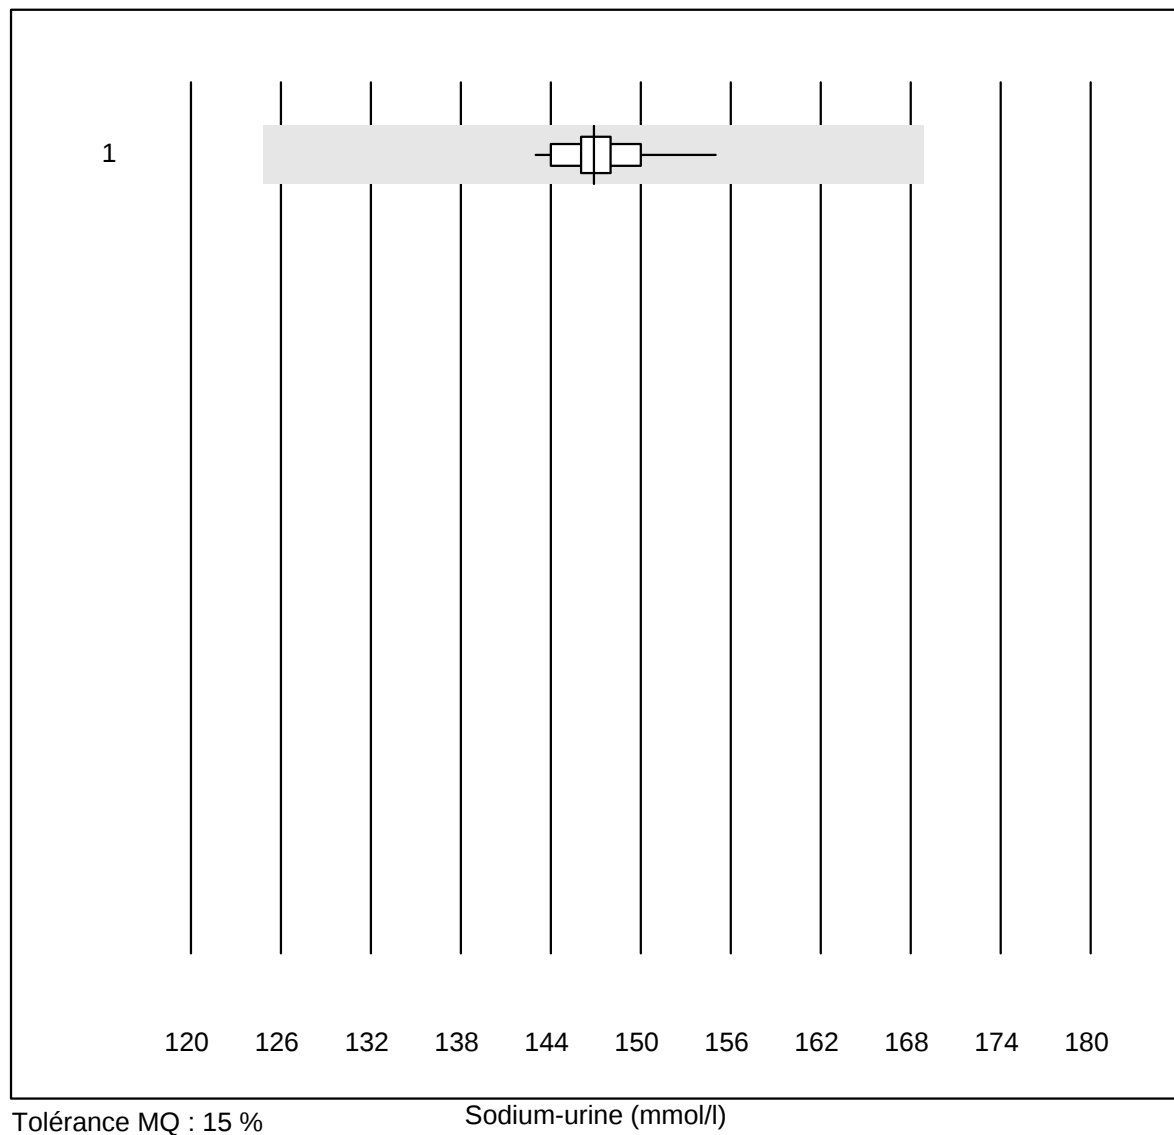


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	25	100.0	0.0	0.0	147	1.7	e

Urée-urine

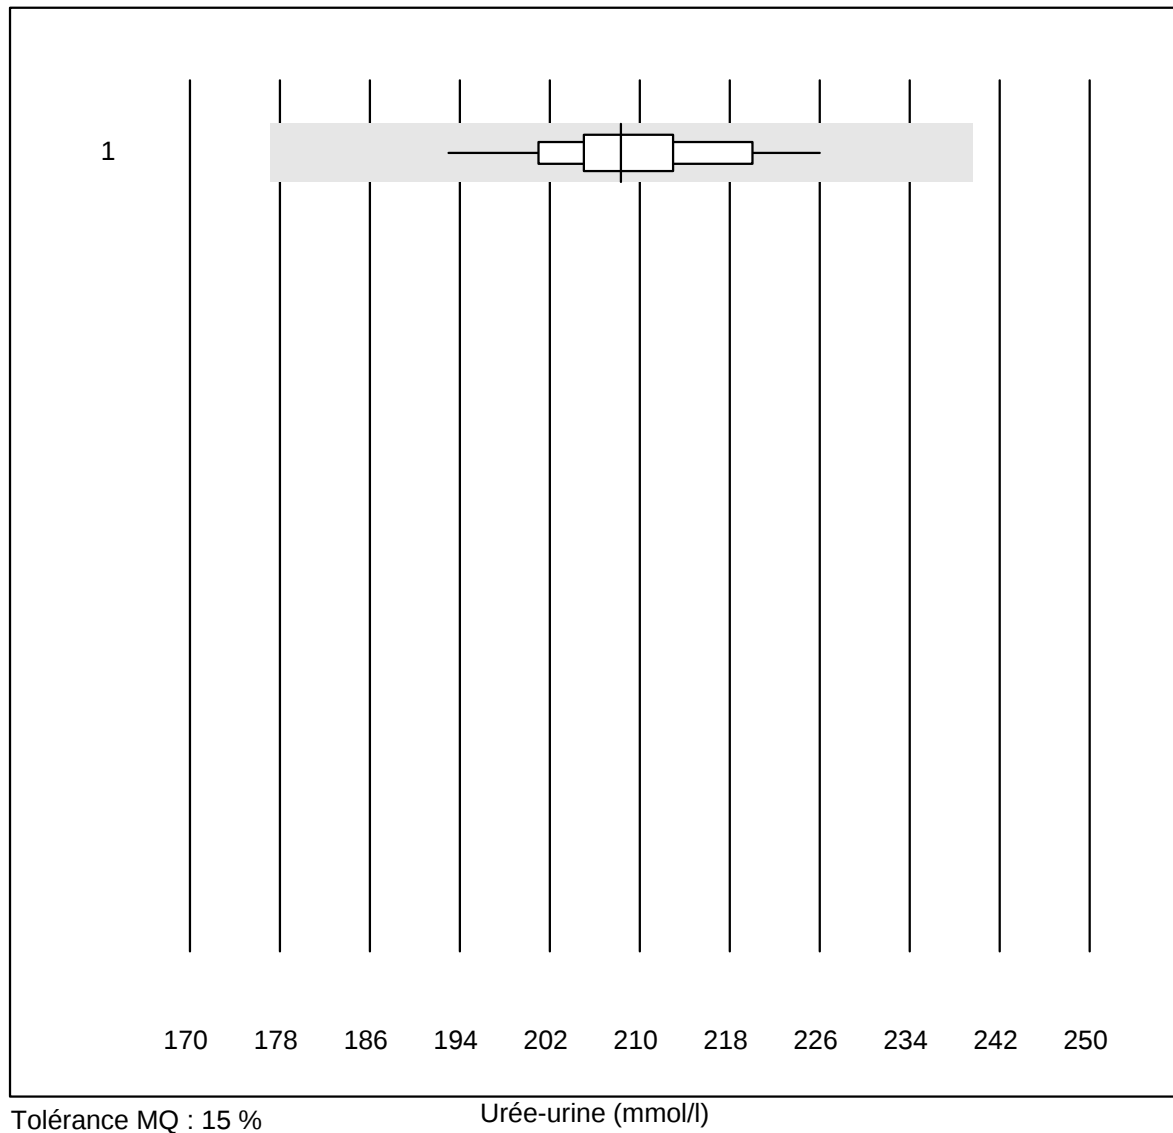


Nr.	Methode	Total	% E fulfil	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	21	100.0	0.0	0.0	208	3.9	e

Acide urique-urine

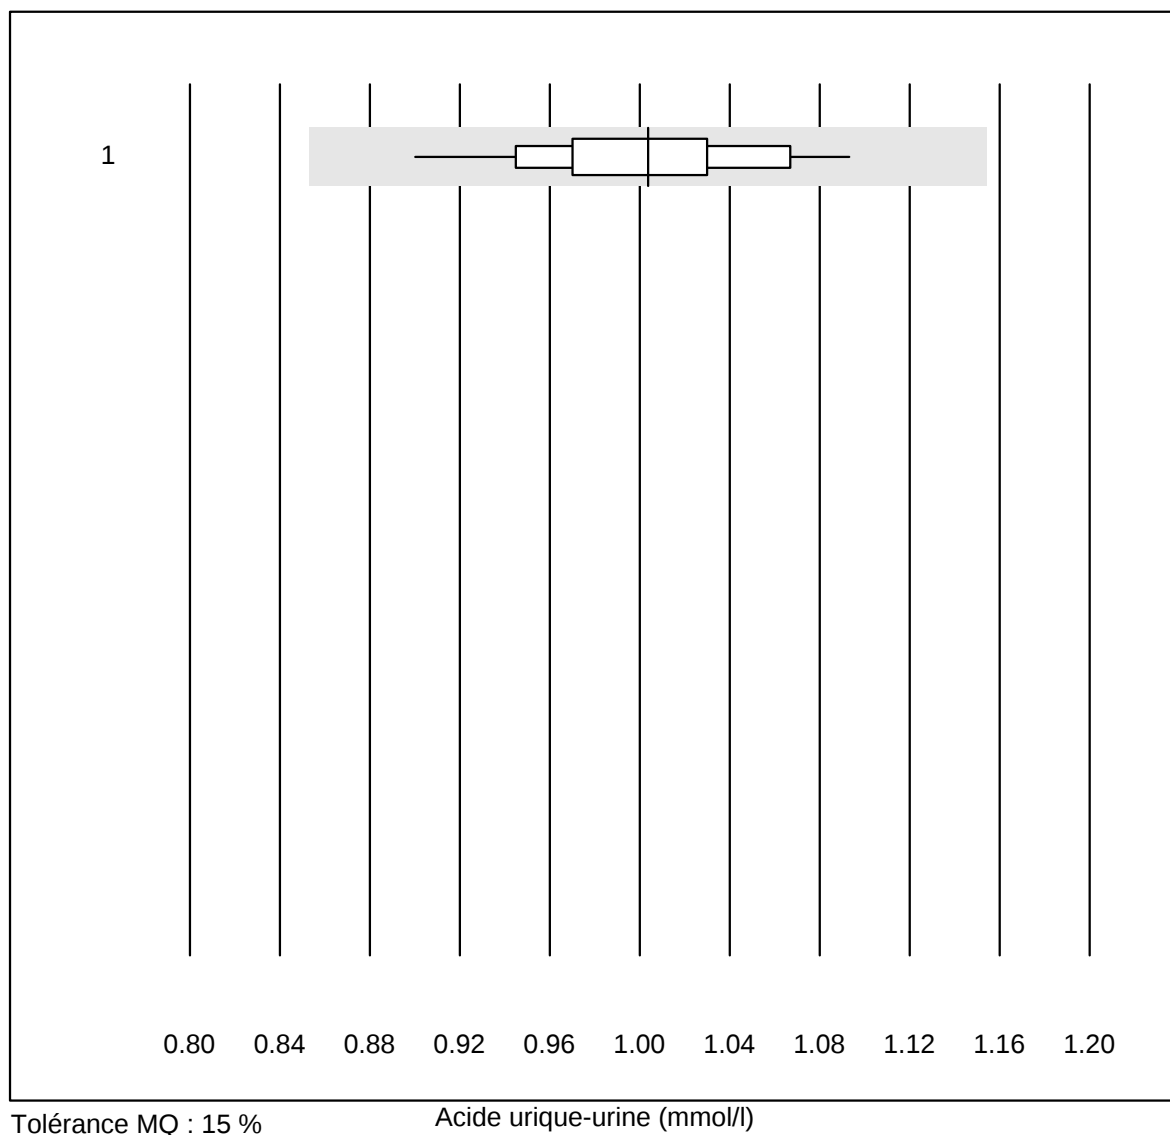

Nr.	Methode	Total	% E fulfil	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	16	100.0	0.0	0.0	1.00	5.0	e

Gravité spécifique-urine

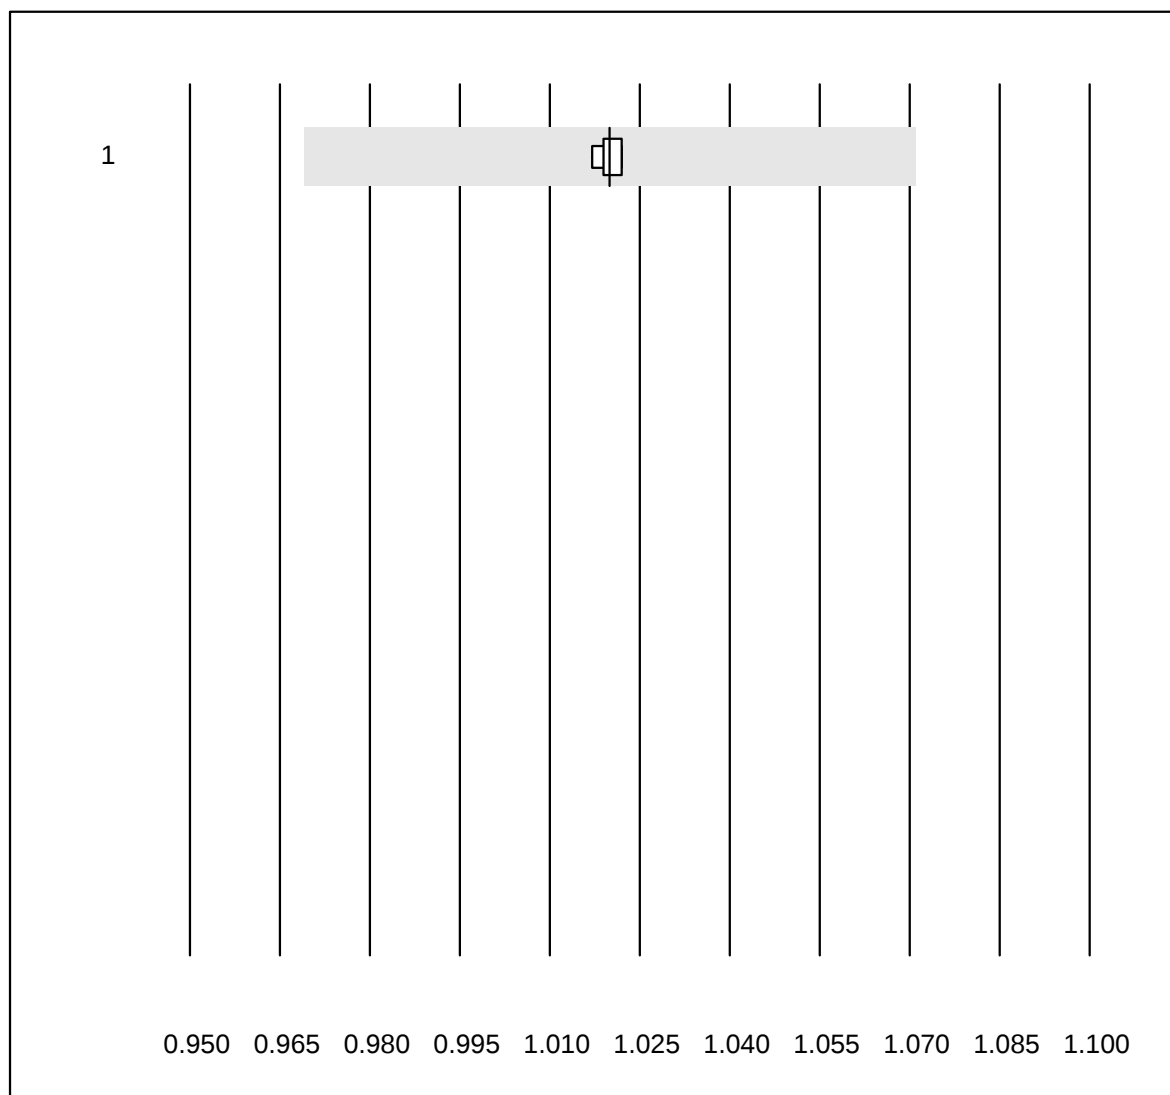


Tolérance MQ : 5 %

Gravité spécifique-urine ()


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Refraktometer	6	100.0	0.0	0.0	1.020	0.2	e

Microalbumine

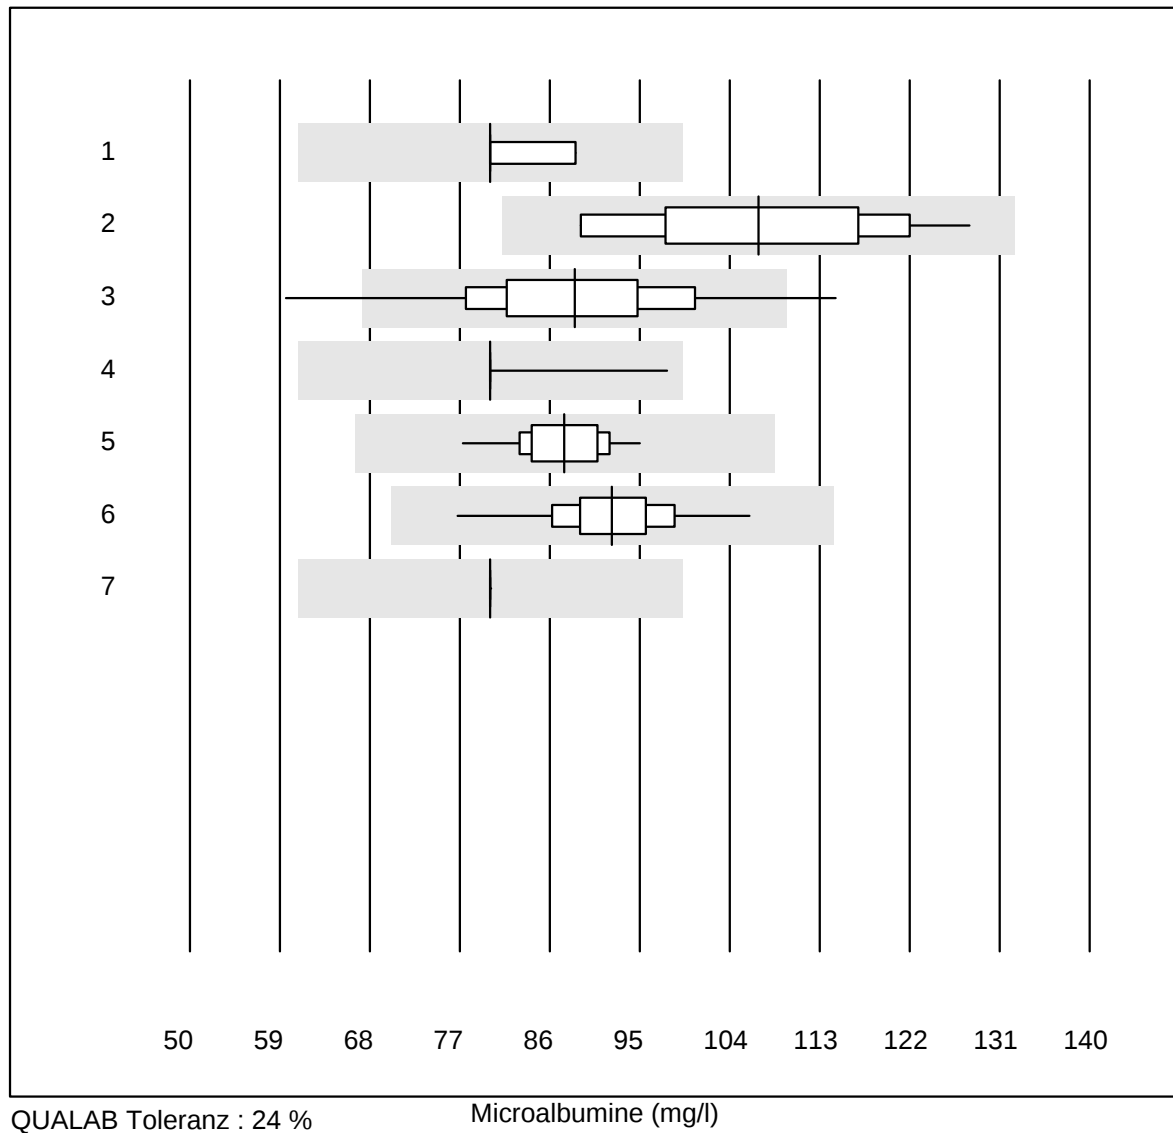

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Aution	4	100.0	0.0	0.0	80.0	5.2	e
2	AFIAS	10	100.0	0.0	0.0	106.9	11.6	e*
3	Afinion	448	94.4	2.0	3.6	88.5	10.4	e
4	Sysmex U	17	64.7	0.0	35.3	80.0	6.5	a
5	Turbidimetrie	26	100.0	0.0	0.0	87.4	4.5	e
6	DCA2000/Vantage	144	97.2	0.0	2.8	92.2	5.7	e
7	Siemens Clinitek	13	92.3	0.0	7.7	80.0	0.0	e

Créatinine urine

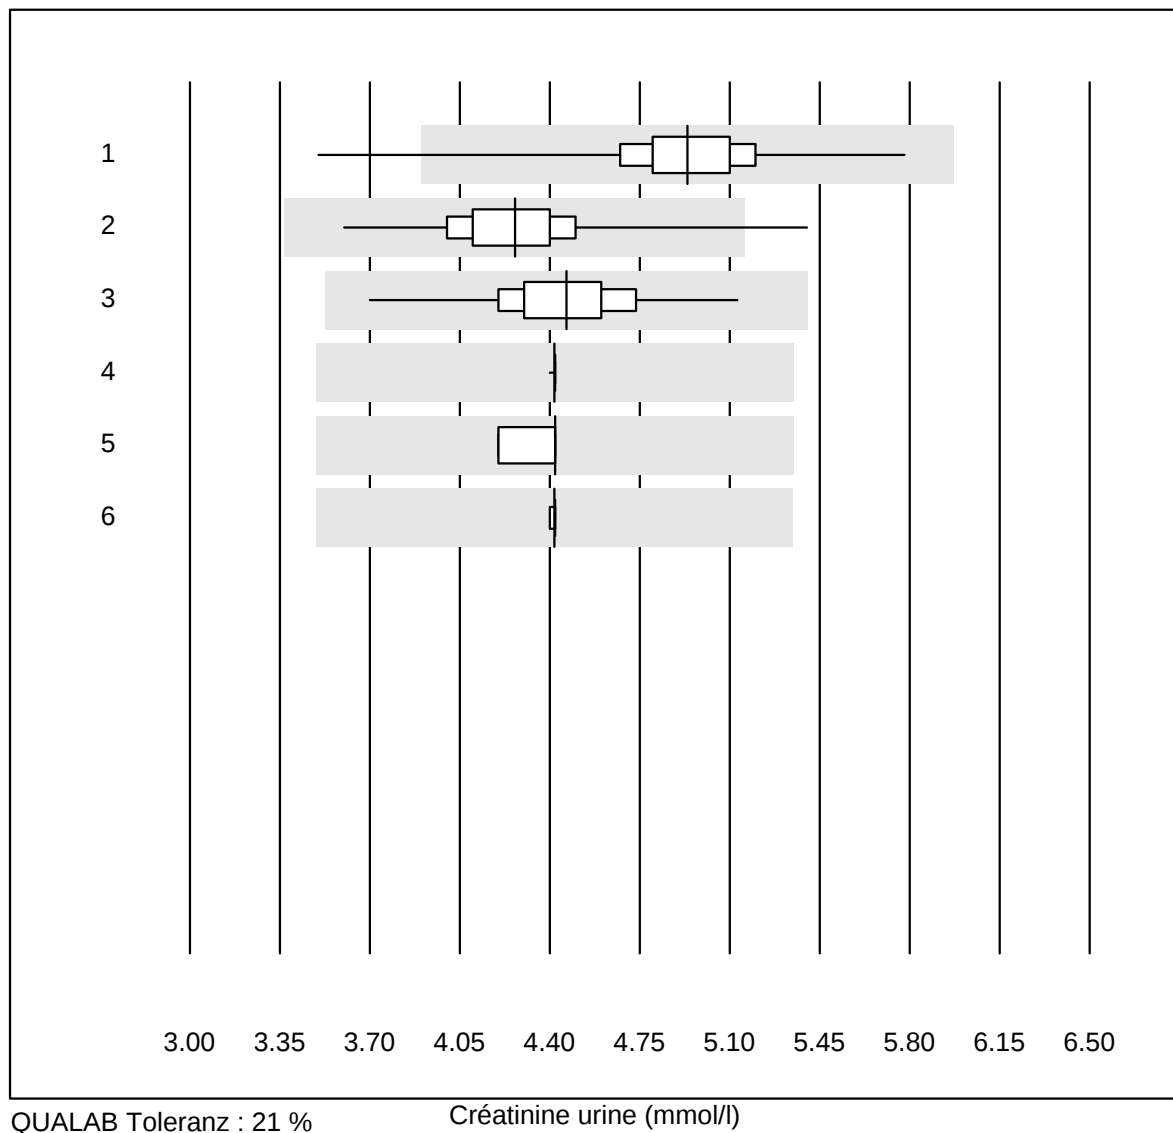

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	DCA2000/Vantage	144	96.5	1.4	2.1	4.9	5.7	e
2	Afinion	447	97.6	0.4	2.0	4.3	5.0	e
3	Chimie humide	40	100.0	0.0	0.0	4.5	5.6	e
4	Sysmex U	15	73.3	0.0	26.7	4.4	0.1	e
5	Aution	4	100.0	0.0	0.0	4.4	2.5	e
6	Siemens Clinitek	13	61.5	0.0	38.5	4.4	0.2	e