

Verein für
Association pour le
Associazione per il



medizinische Qualitätskontrolle
contrôle de qualité médical
controllo di qualità medico

Commentaire de l'essai interlaboratoire

2021 - 1

Échantillons de l'essai interlaboratoire

L'homogénéité et la stabilité ont été vérifiées pour tous les échantillons avant respectivement pendant l'envoi et aucune anomalie n'a été constatée. Les tests de conformité ont été réalisés par les laboratoires de l'Hôpital Universitaire de Zürich (<http://www.uzl.usz.ch/>).

Ont été produits spécifiquement pour MQ en sous-traitance les échantillons d'essai interlaboratoire suivants:

B1 Strep A Test, B2 Uricult, H4 Hématologie parasitaire, K14 Marqueur tumoral

Détermination des valeurs-cible

Pour chaque valeur-cible est indiqué le mode de détermination utilisé selon les termes de la norme ISO17043:2010, B2.1 (Colonne "Type"):

- a Valeur connue, sur la base de la production.
- b Valeur de référence certifiée lors de l'utilisation d'échantillons spécifiques
- c Valeur de référence déterminée par analyse
- d „Consensus value“ des laboratoires d'experts
- e „Consensus value“ des participants

Pour les groupes de méthode incluant plus de 9 participants, les valeurs cibles sont déterminées comme étant la „Consensus value“ ("e") des participants. Pour la détermination de ces valeurs cibles est utilisée la moyenne réalisée par le groupe de méthodes. Les résultats qui présentent un écart par rapport à la valeur cible supérieur à 1.5 fois la tolérance Qualab, sont considérés comme résultats aberrants et exclus du calcul de la valeur de référence. Les résultats des essais d'aptitude sont utilisés comme valeur de base pour éliminer les taux aberrants. Afin de mettre à disposition de tous les participants des valeurs-cible les plus pertinentes possibles, d'autres procédures peuvent également être utilisées pour des groupes de méthode plus restreints.

Incertitude dans la détermination des valeurs-cible

L'incertitude-type (u_x) est calculée à l'aide de la formule suivante (ISO13528):

$$u_x = (\text{Valeur-cible}/100) * (1.25/\text{Racine carrée du "nombre des participants"}) * \text{CV en \%}$$

- u_x est exprimée dans la même unité que la valeur-cible
- u_x peut être comparée avec l'écart-type du collectif des participants ($\text{Ecart-type} = \text{Valeur-cible} * \text{CV en \%} / 100$)
- Pour un nombre de participants >18, l'incertitude-type (u_x) est significativement plus petite que la dispersion du collectif des participants et peut donc être négligée.


Tolérances QUALAB et MQ

Pour les analyses obligatoires sont utilisées les tolérances fixées par Qualab (www.qualab.ch, contrôle de qualité externe). Pour les analyses non-obligatoires, les tolérances sont fixées par le directeur de MQ pilotant l'essai interlaboratoire.

Si l'incertitude déterminée de la valeur de référence u_x est supérieure à 15% de la tolérance QUALAB ou de MQ, la lettre qui caractérise le type de détermination de la valeur-cible est en outre marquée d'une étoile (par exemple "e*"). Nous rendons ainsi les participants attentifs au fait que l'incertitude de la valeur de référence peut avoir une influence sur l'évaluation.

Représentation graphique

La représentation graphique des résultats est la suivante:

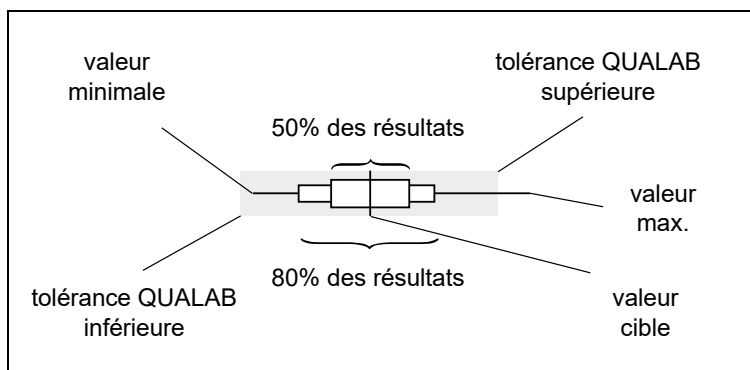


Comparaison des appareils

Les données de ce rapport vous permettent de comparer les performances respectives des divers appareils. Toutefois, vous devez tenir compte des points suivants:

- Le contrôle Chimie K1 est un sérum de contrôle commercialisé prêt à l'emploi. Même si l'échantillon est d'origine humaine, des effets matriciels sont possibles. Ceux-ci dépendent de l'appareil et peuvent générer des valeurs cible différentes.
- Seul un échantillon a été mesuré. La dispersion des résultats étant dépendante de la nature de l'échantillon (effets matriciels) et du niveau du résultat, les coefficients de variation déterminés (CV en %) ne sont pas toujours valables.
- Une grande partie des taux aberrants est due à des erreurs administratives (erreur d'unité, confusion des résultats) ou à des erreurs de manipulation (erreur d'échantillon, dissolution incorrecte, mélange insuffisant) et n'a rien à voir avec le type d'appareil.


Zürich, 8.4.2021



Dr. R. Fried
Directeur de l'essai interlaboratoire


Il n'est pas autorisé de publier une partie ou l'intégralité de ce rapport sans notre accord écrit préalable. L'original est conservé dans les archives sous www.mqzh.ch.

Quick OA

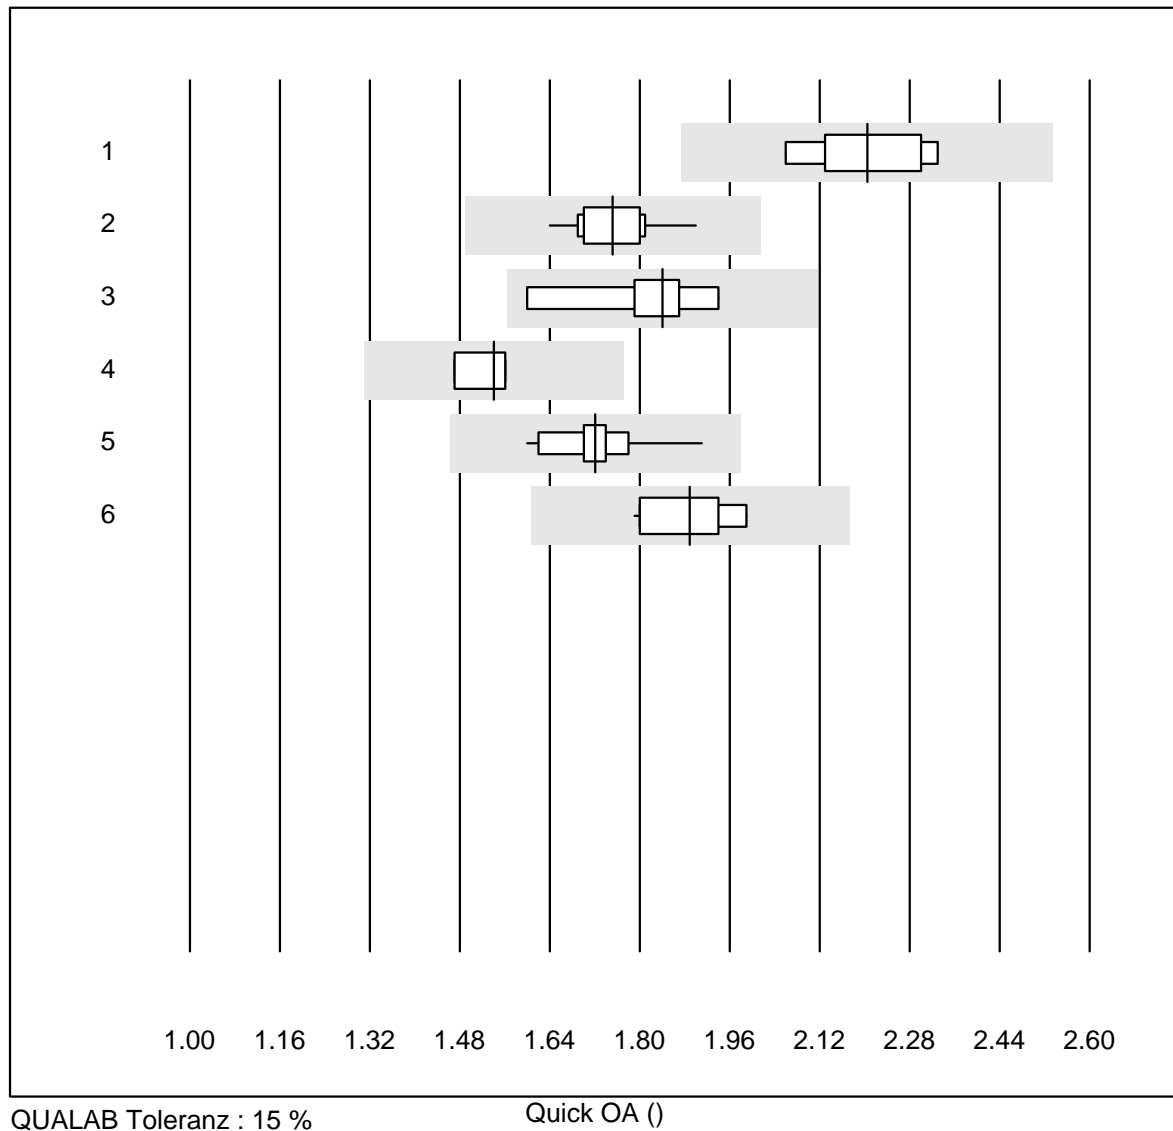

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Neoplastin Plus	6	100.0	0.0	0.0	2.21	4.6	e*
2 Innovin	14	100.0	0.0	0.0	1.75	3.7	e
3 Recombiplastin 2G	9	100.0	0.0	0.0	1.84	6.0	e*
4 Eurolyser	4	75.0	0.0	25.0	1.54	3.0	e
5 Autres méthodes	13	100.0	0.0	0.0	1.72	4.4	e
6 Neoplastin R	12	100.0	0.0	0.0	1.89	3.9	e

Fibrinogène OA

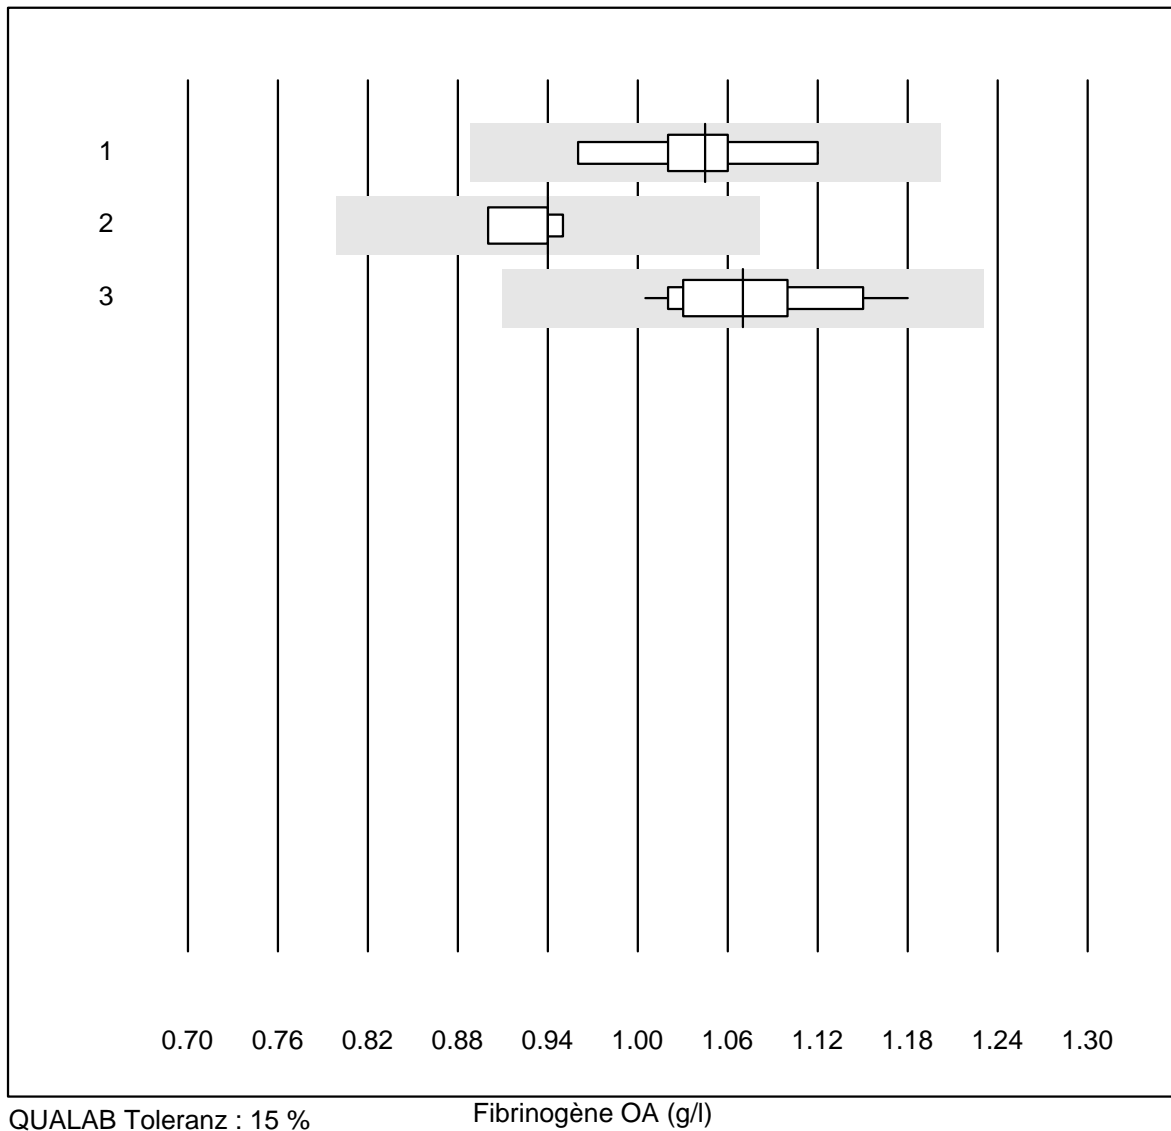


QUALAB Toleranz : 15 %

Fibrinogène OA (g/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Autres méthodes	8	100.0	0.0	0.0	1.05	4.8	e
2	Siemens Thrombin	4	100.0	0.0	0.0	0.94	2.4	e
3	Stago/STA	16	100.0	0.0	0.0	1.07	4.9	e

aPTT OA

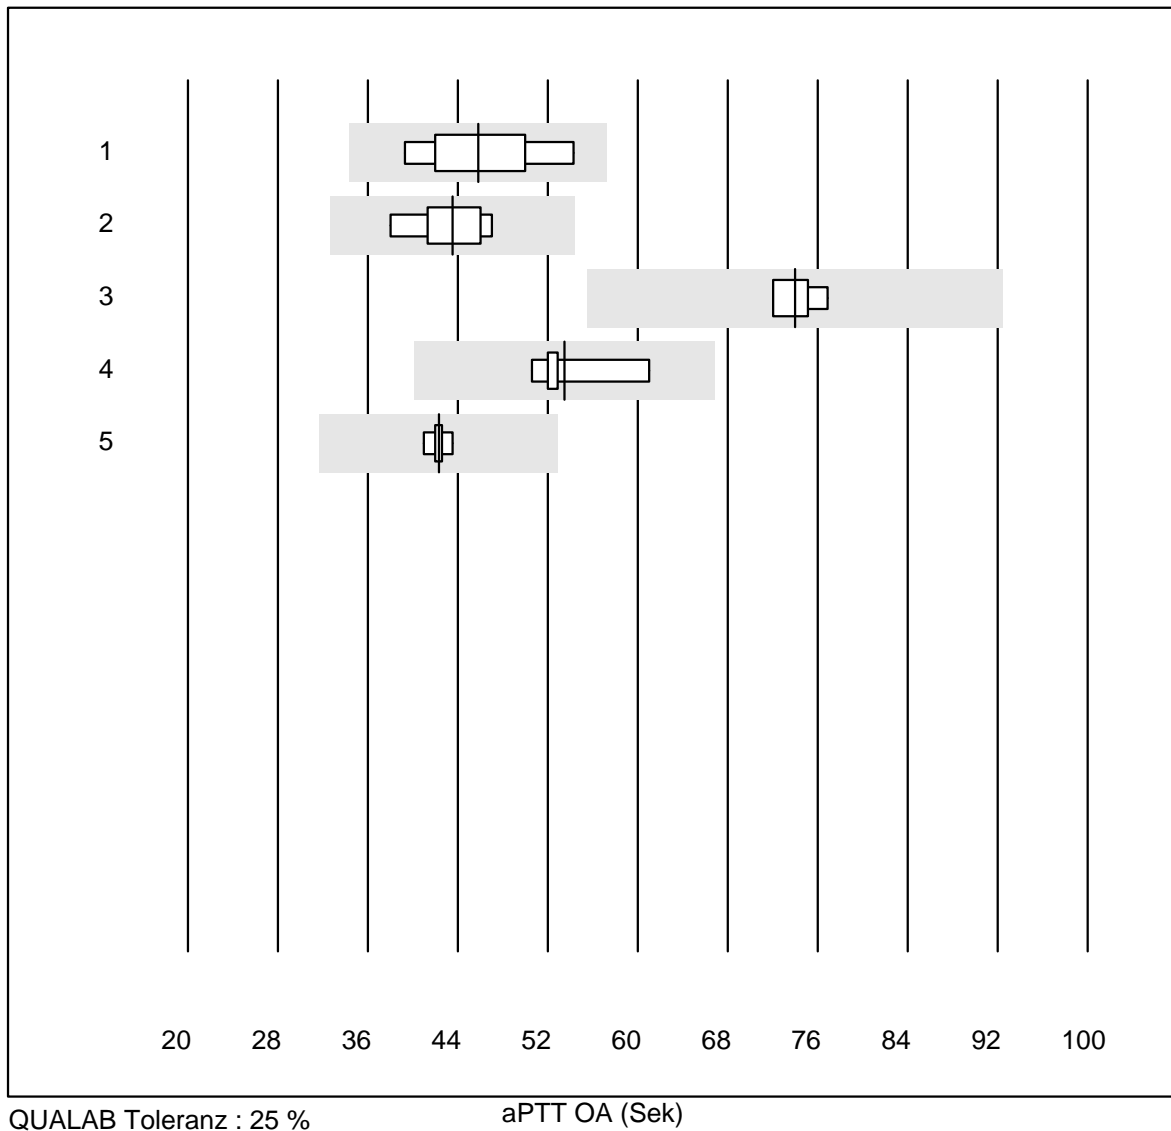

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Autres méthodes	9	100.0	0.0	0.0	45.8	11.5	e*
2 Actin FS	6	100.0	0.0	0.0	43.5	7.9	e*
3 Pathromtin SL	4	100.0	0.0	0.0	74.0	3.0	e
4 Stago/STA	14	100.0	0.0	0.0	53.5	6.4	e
5 aPTT-SP	5	100.0	0.0	0.0	42.3	2.2	e

INR CoaguChek

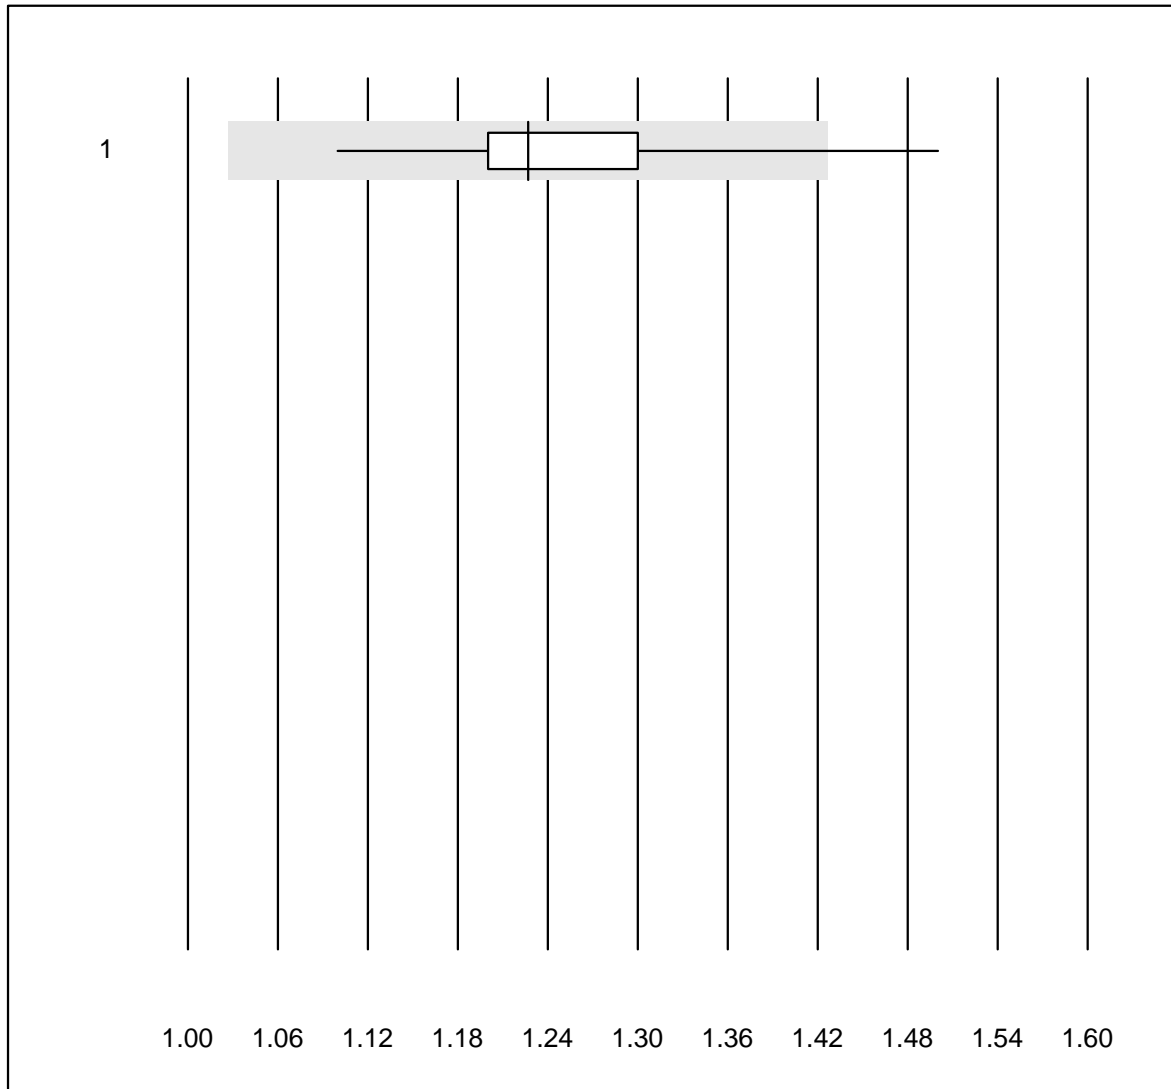


QUALAB Toleranz : 15 %
(< 1.3: +/- 0.2)

INR CoaguChek ()


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	CoaguChek Pro II	630	99.2	0.3	0.5	1.2	4.0	e

Quick N

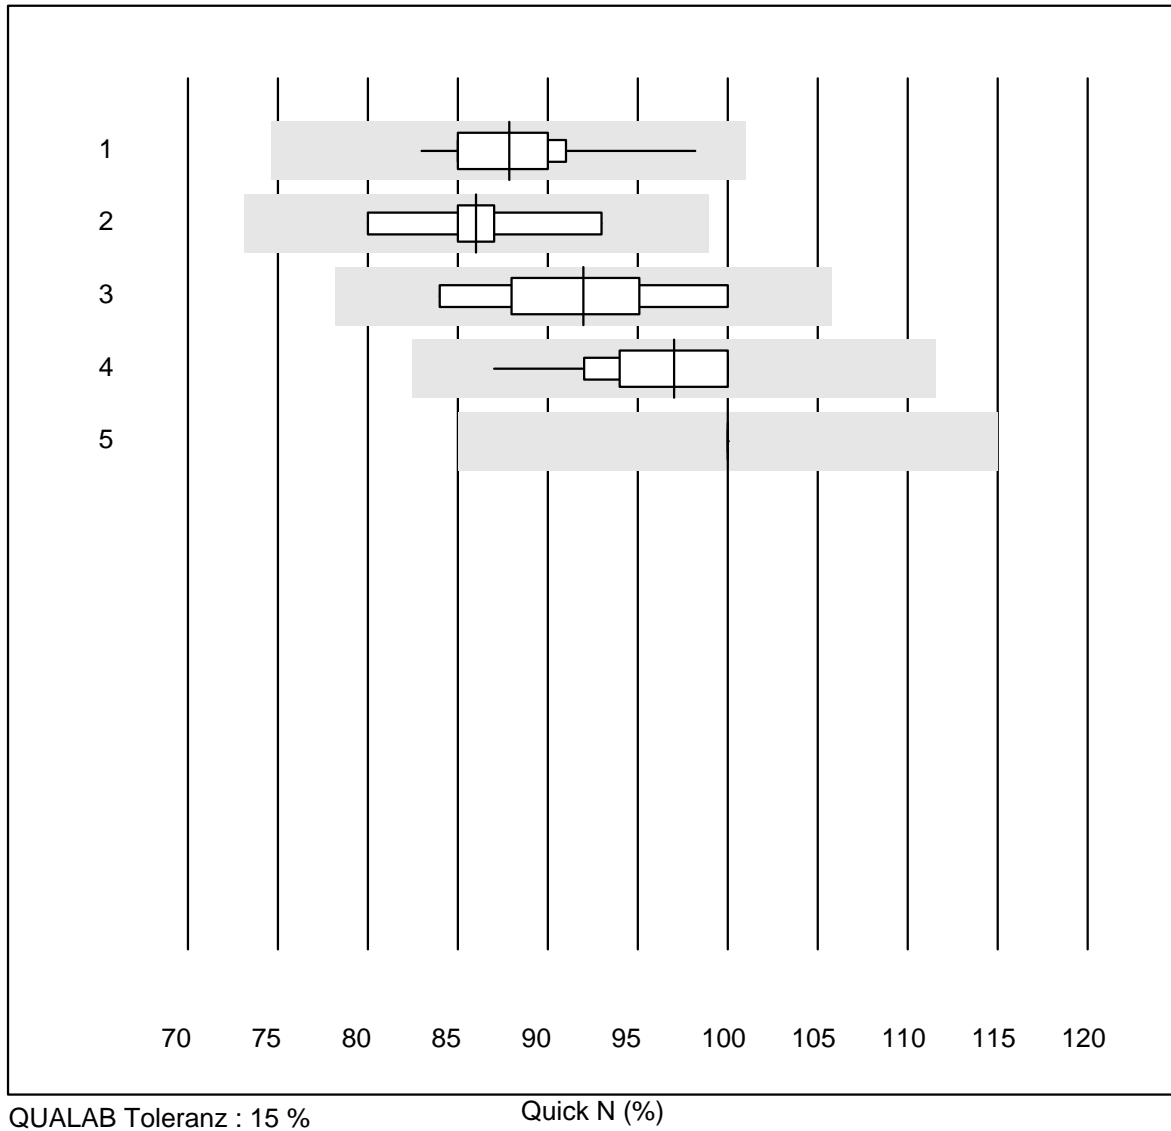

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Neoplastin R	12	100.0	0.0	0.0	88	4.7	e
2 Neoplastin Plus	6	100.0	0.0	0.0	86	4.8	e*
3 Innovin	10	100.0	0.0	0.0	92	6.1	e*
4 toutes les méthodes	11	100.0	0.0	0.0	97	4.4	e
5 Recombiplastin 2G	6	100.0	0.0	0.0	100	0.0	e

Faktor II

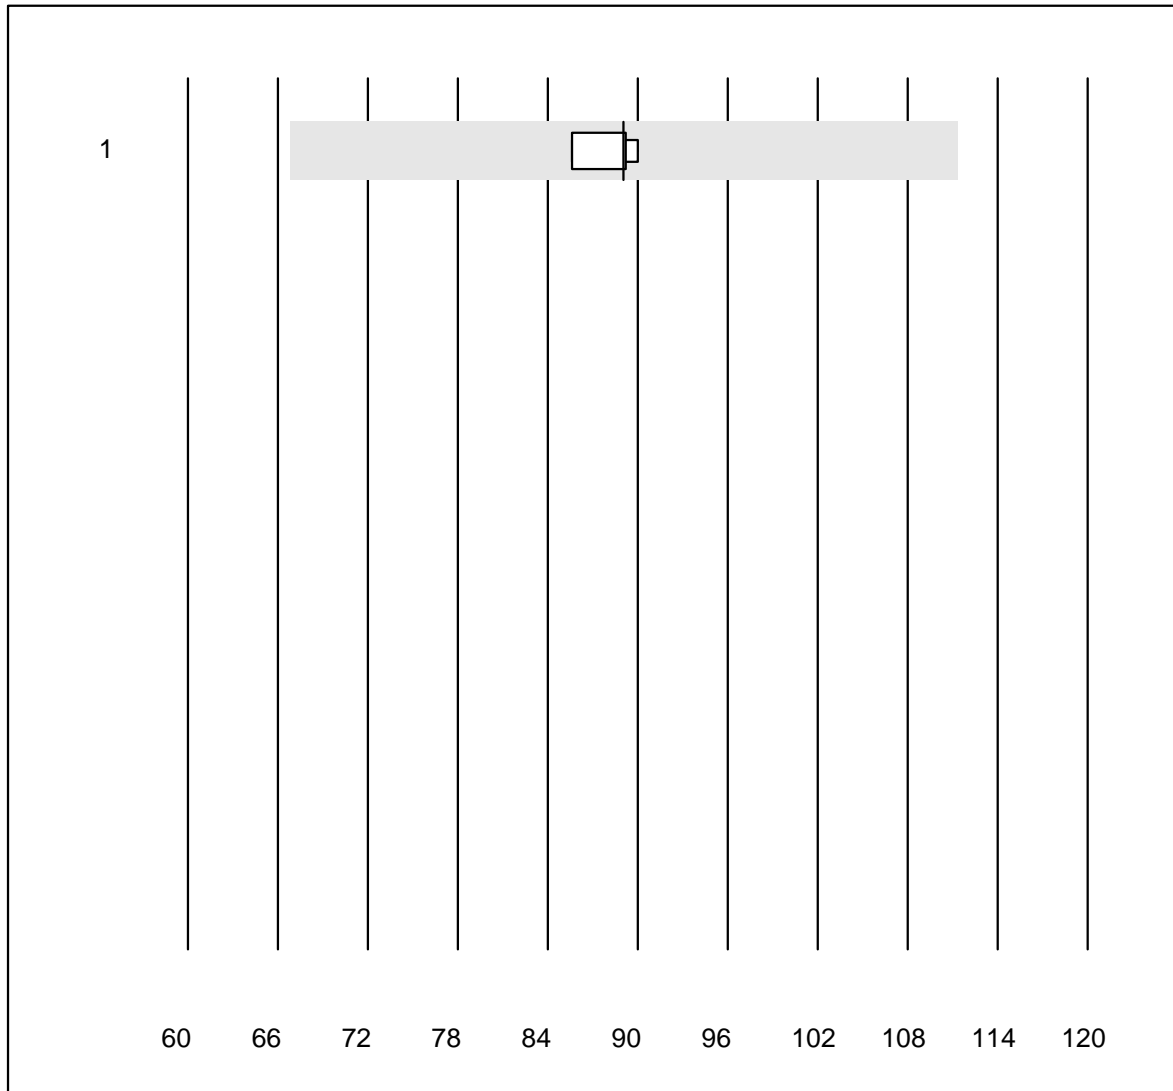


Tolérance MQ : 25 %

Faktor II (%)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	89.1	2.2	e

Fibrinogen N

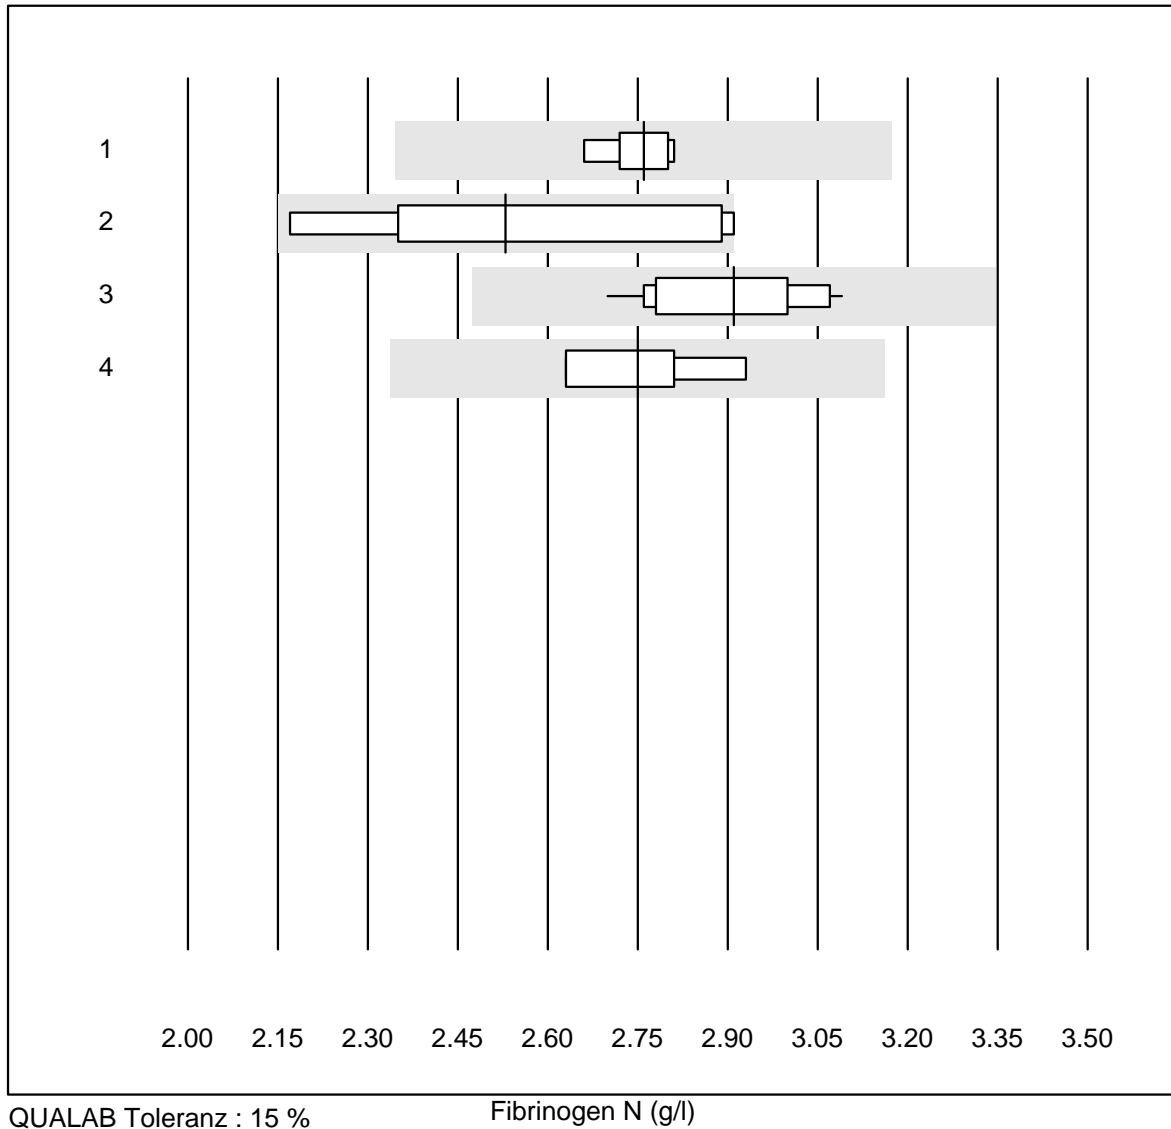

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Siemens Thrombin	6	100.0	0.0	0.0	2.76	2.2	e
2	Autres méthodes	7	85.7	14.3	0.0	2.53	11.4	e*
3	Stago/STA	18	100.0	0.0	0.0	2.91	4.1	e
4	Fibrinogen Q.F.A.	6	100.0	0.0	0.0	2.75	4.2	e

Faktor V

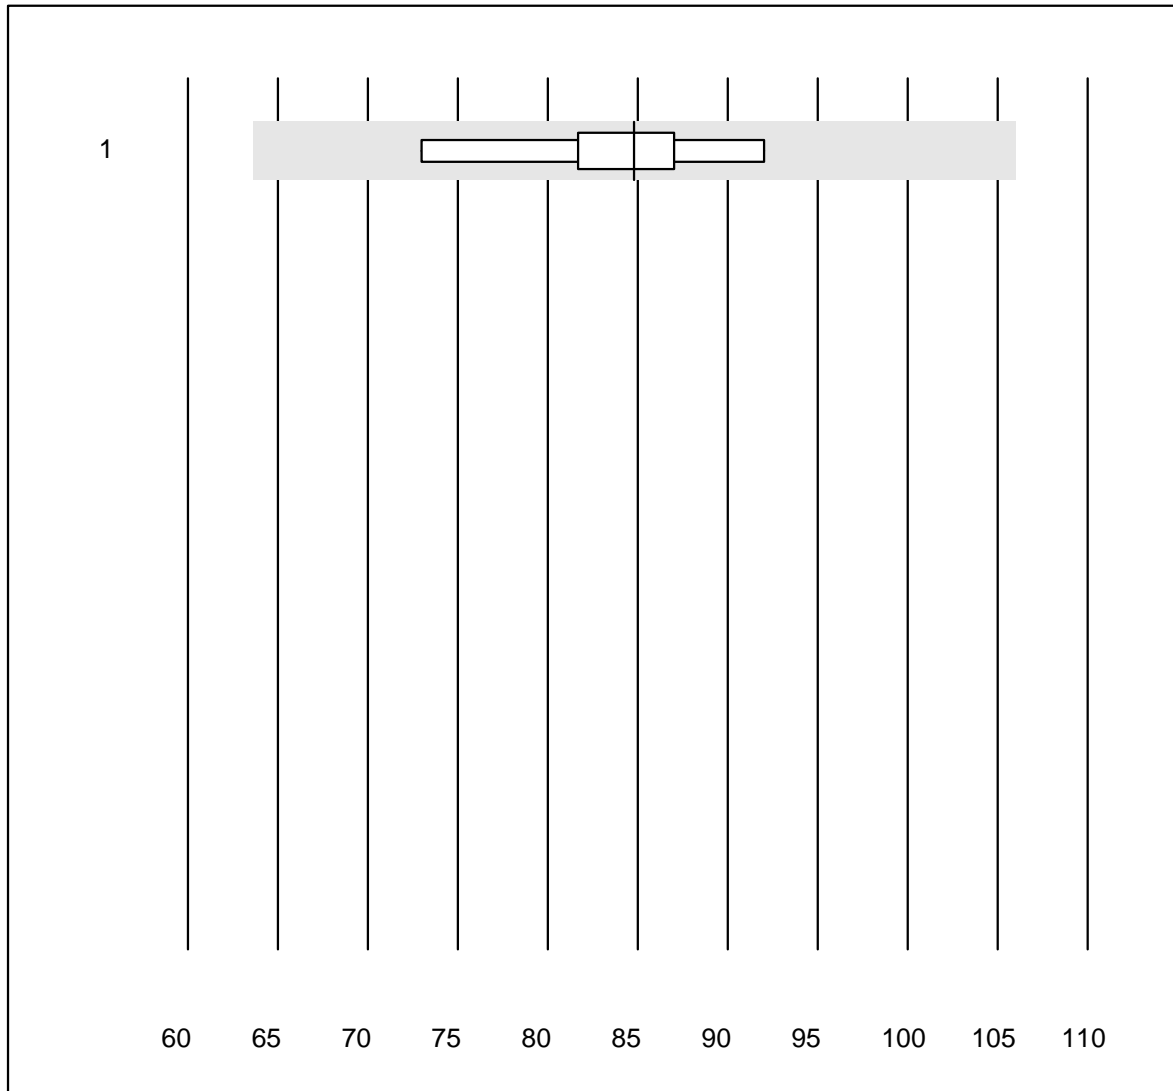


Tolérance MQ : 25 %

Faktor V (%)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	84.8	7.0	e

aPTT N

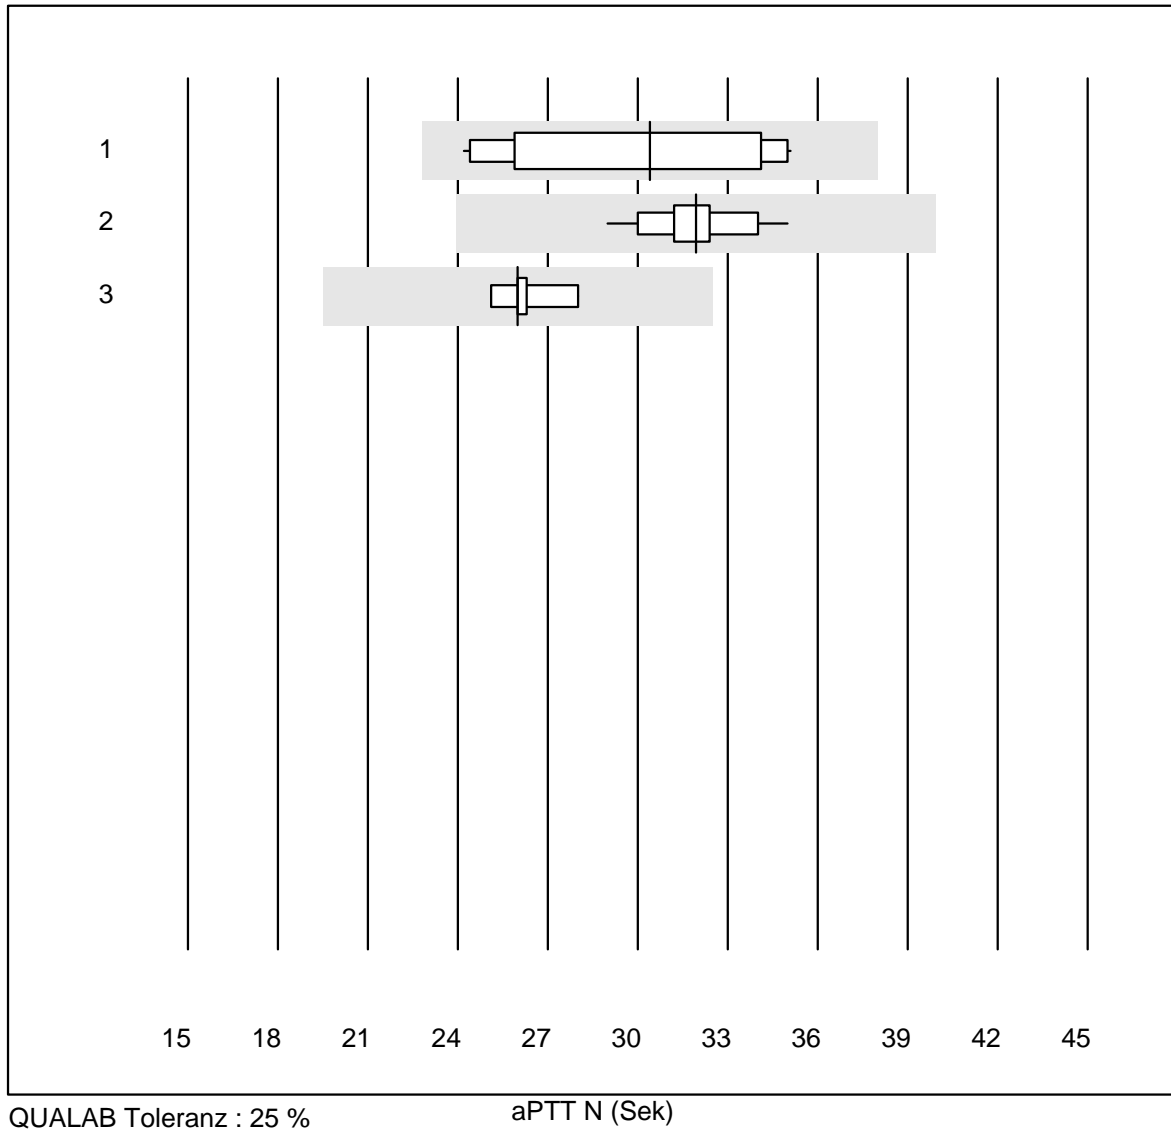


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Autres méthodes	12	100.0	0.0	0.0	30.4	14.9	e*
2 Stago/STA	17	100.0	0.0	0.0	31.9	4.3	e
3 aPTT-SP	9	100.0	0.0	0.0	26.0	2.9	e

Faktor VII

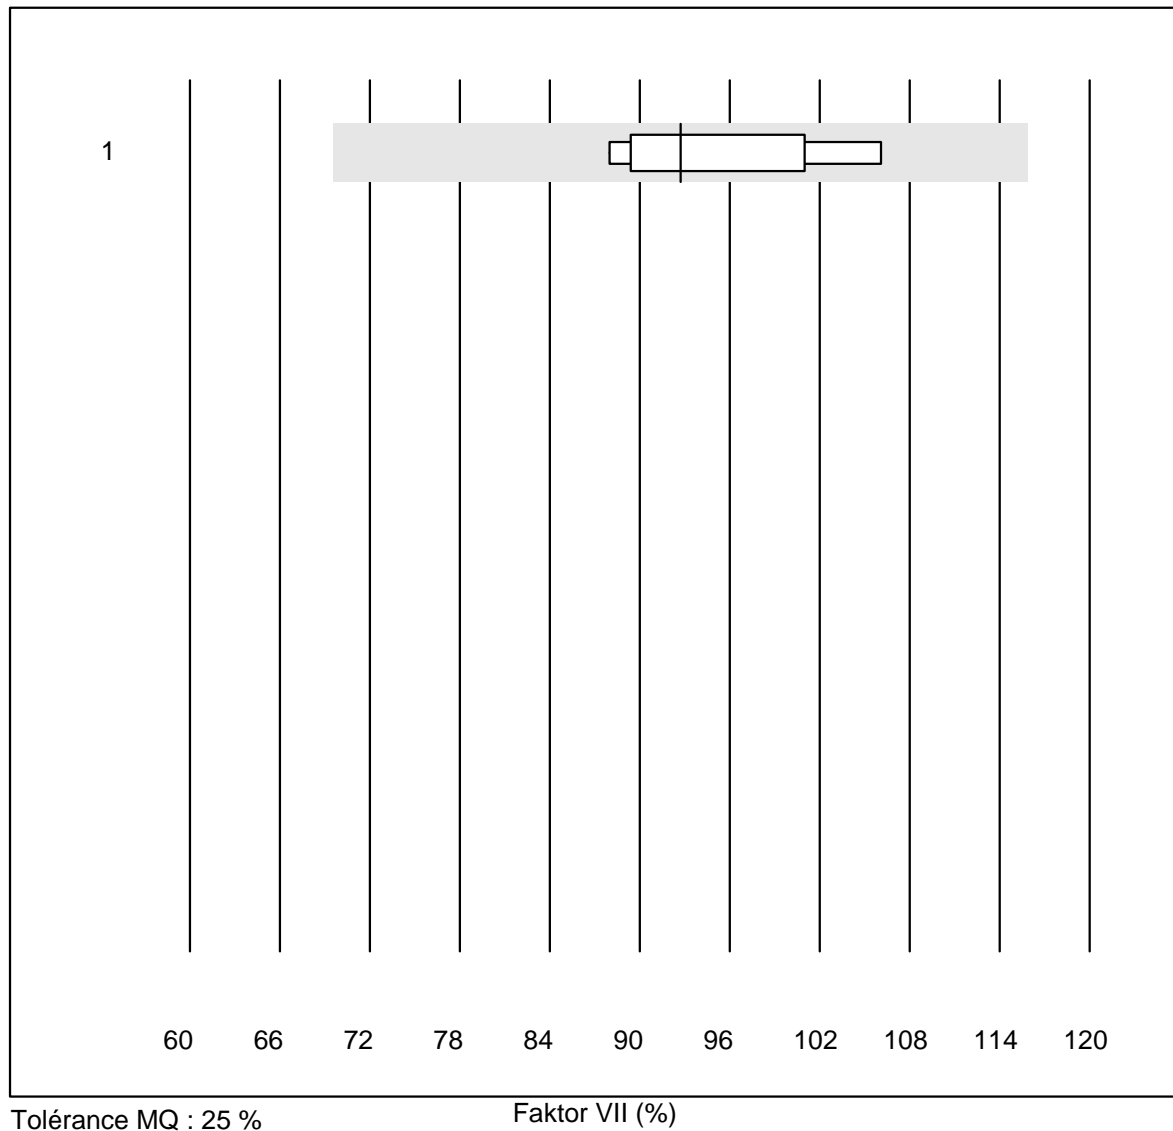


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	92.7	8.2	e*

Quick H

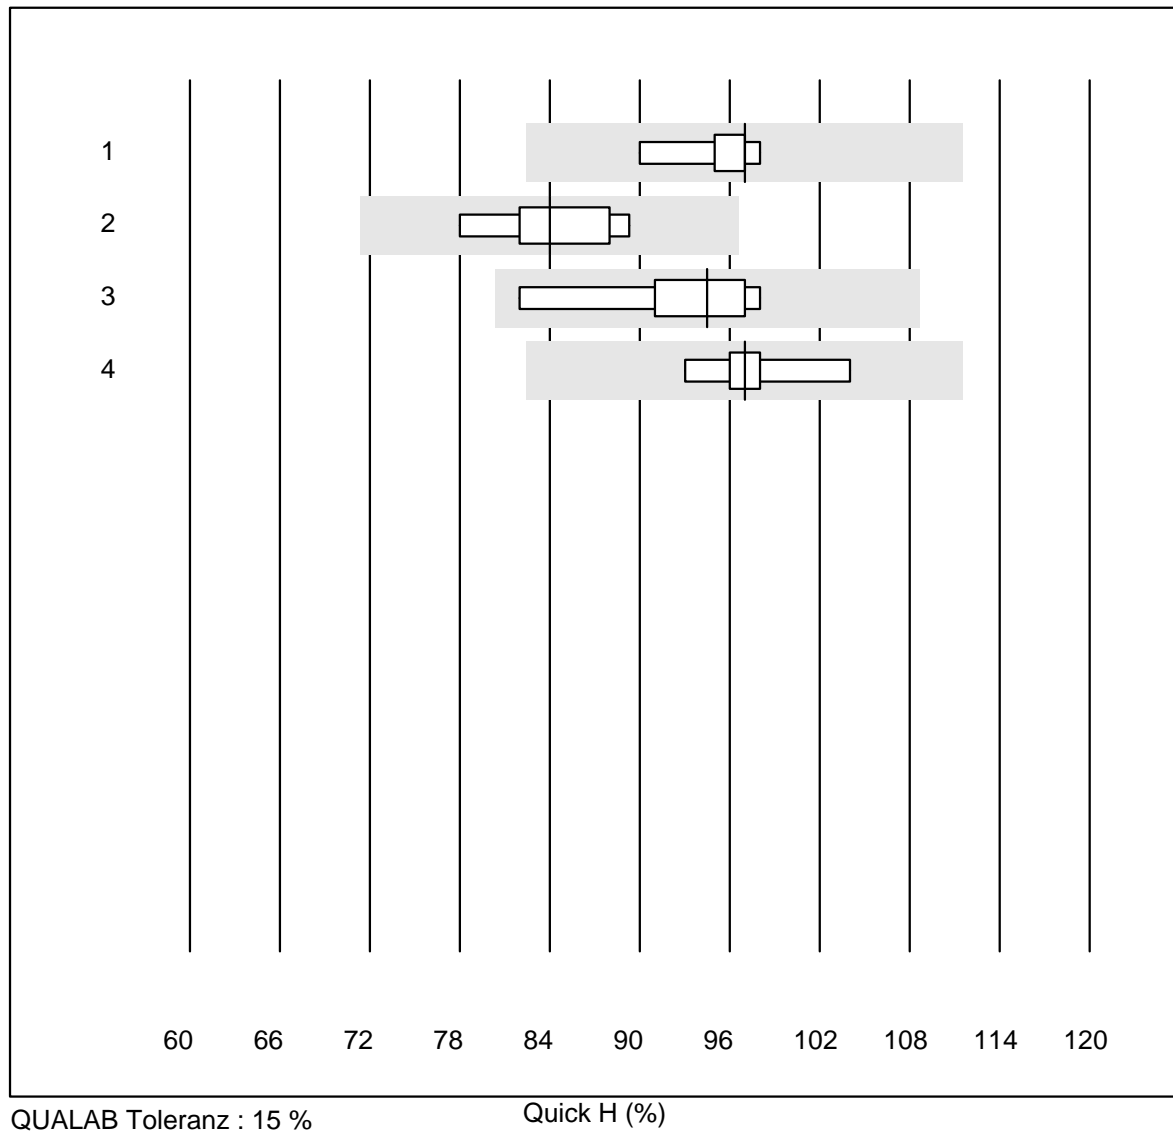

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Neoplastin R	9	100.0	0.0	0.0	97	2.6	e
2	Innovin	8	100.0	0.0	0.0	84	4.7	e
3	toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	95	6.3	e*
4	Recombiplastin 2G	9	100.0	0.0	0.0	97	3.3	e

Anti-FXa (unfrakt-Heparin)

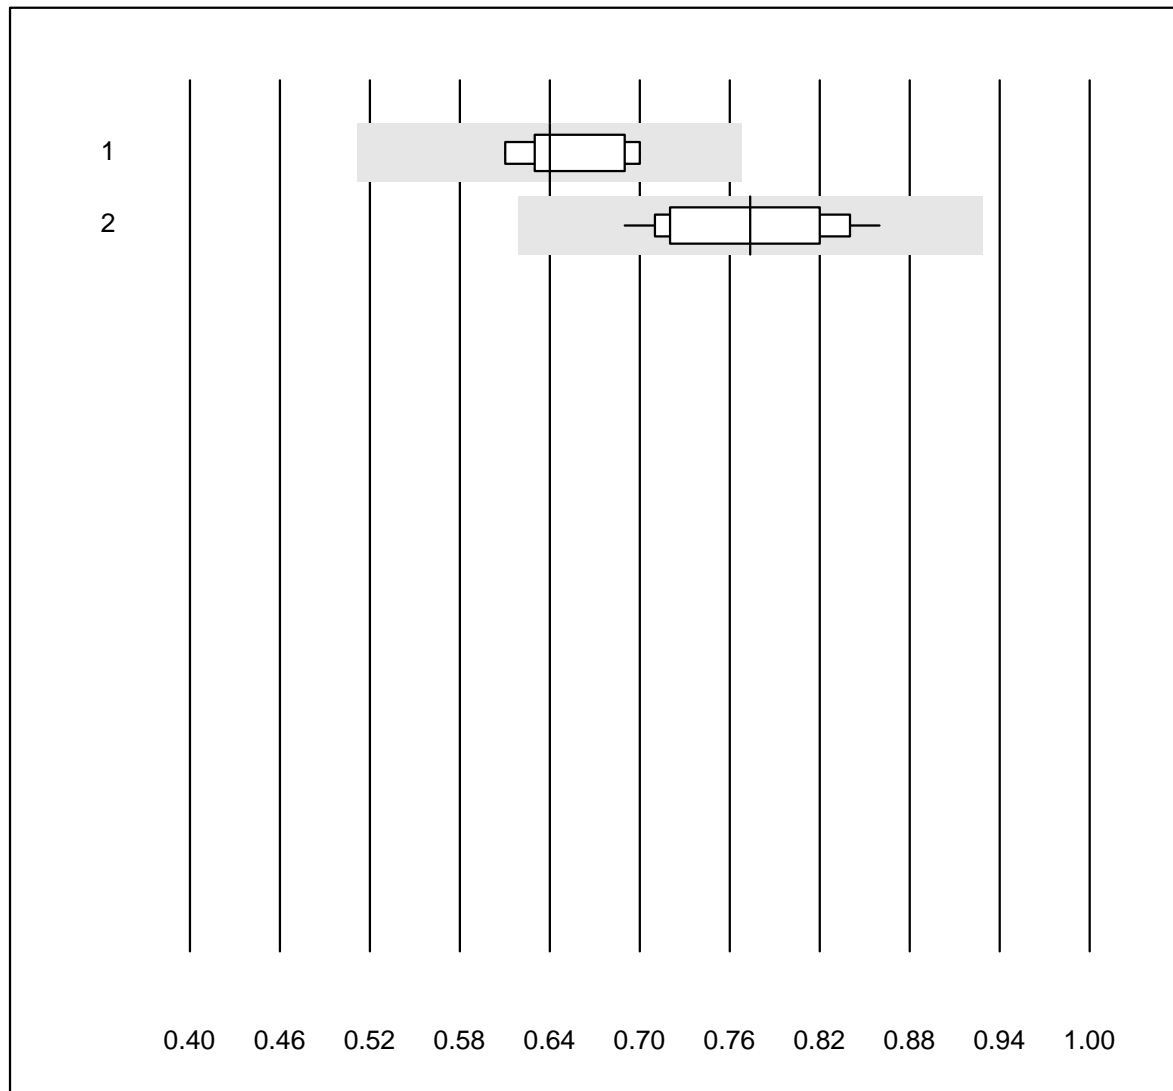

Tolérance MQ : 20 %

Anti-FXa (unfrakt-Heparin) (IU/ml)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Stago/STA	7	100.0	0.0	0.0	0.64	5.0	e
2 ACL	12	100.0	0.0	0.0	0.77	7.1	e

Fibrinogen H



Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Siemens Thrombin	4	100.0	0.0	0.0	2.77	3.7	e*
2	Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	2.63	11.4	a
3	Stago/STA	12	100.0	0.0	0.0	2.95	3.9	e
4	Fibrinogen Q.F.A.	10	100.0	0.0	0.0	2.77	6.9	e*

aPTT H

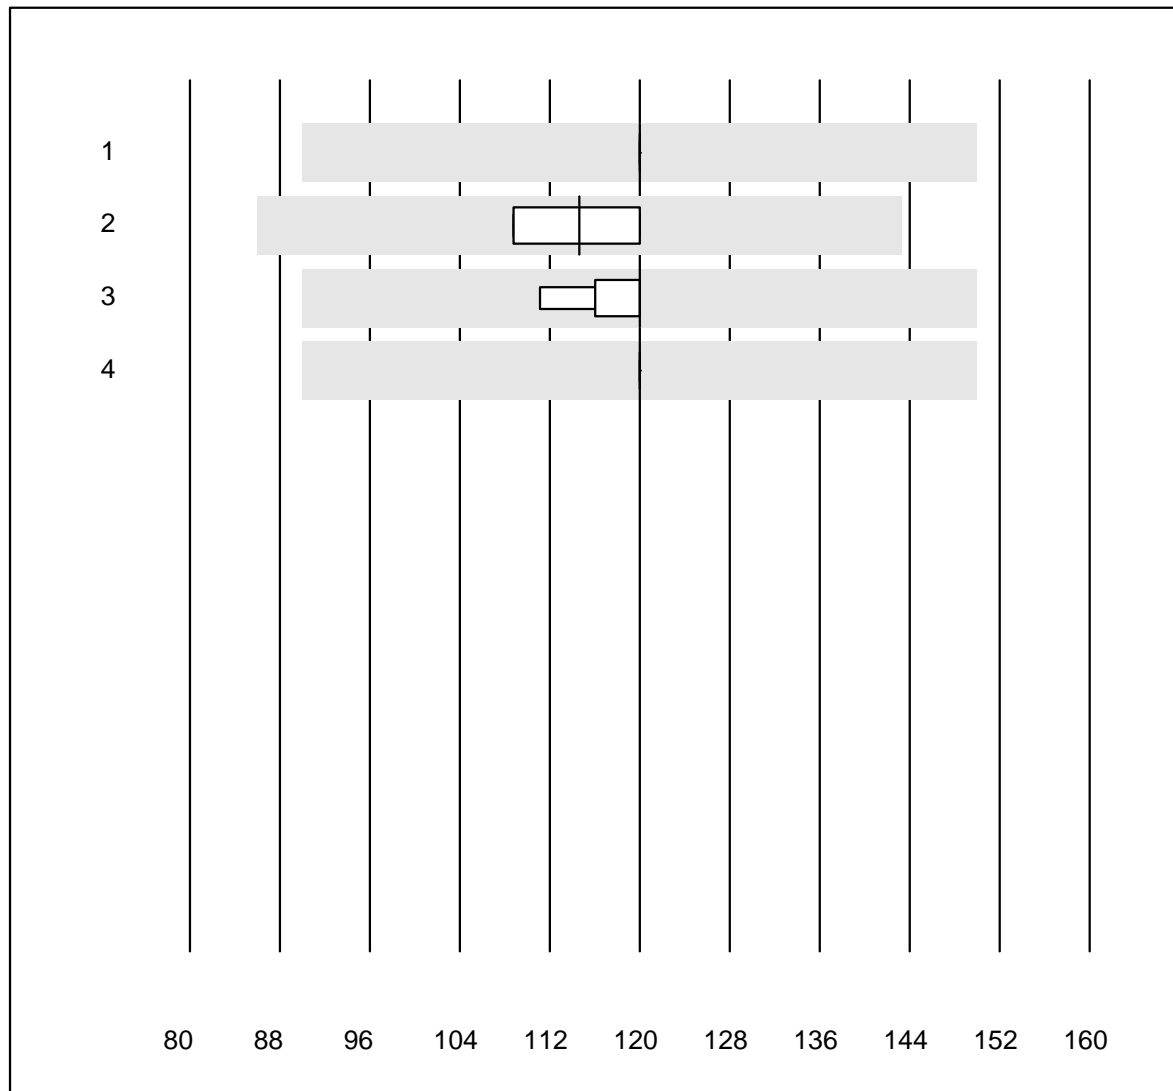


QUALAB Toleranz : 25 %

aPTT H (Sek)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Actin FS	4	100.0	0.0	0.0	120.0	0.0	e
2 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	114.6	5.5	e
3 Stago/STA	9	100.0	0.0	0.0	120.0	2.7	e
4 aPTT-SP	10	100.0	0.0	0.0	120.0	0.0	e

D-Dimères

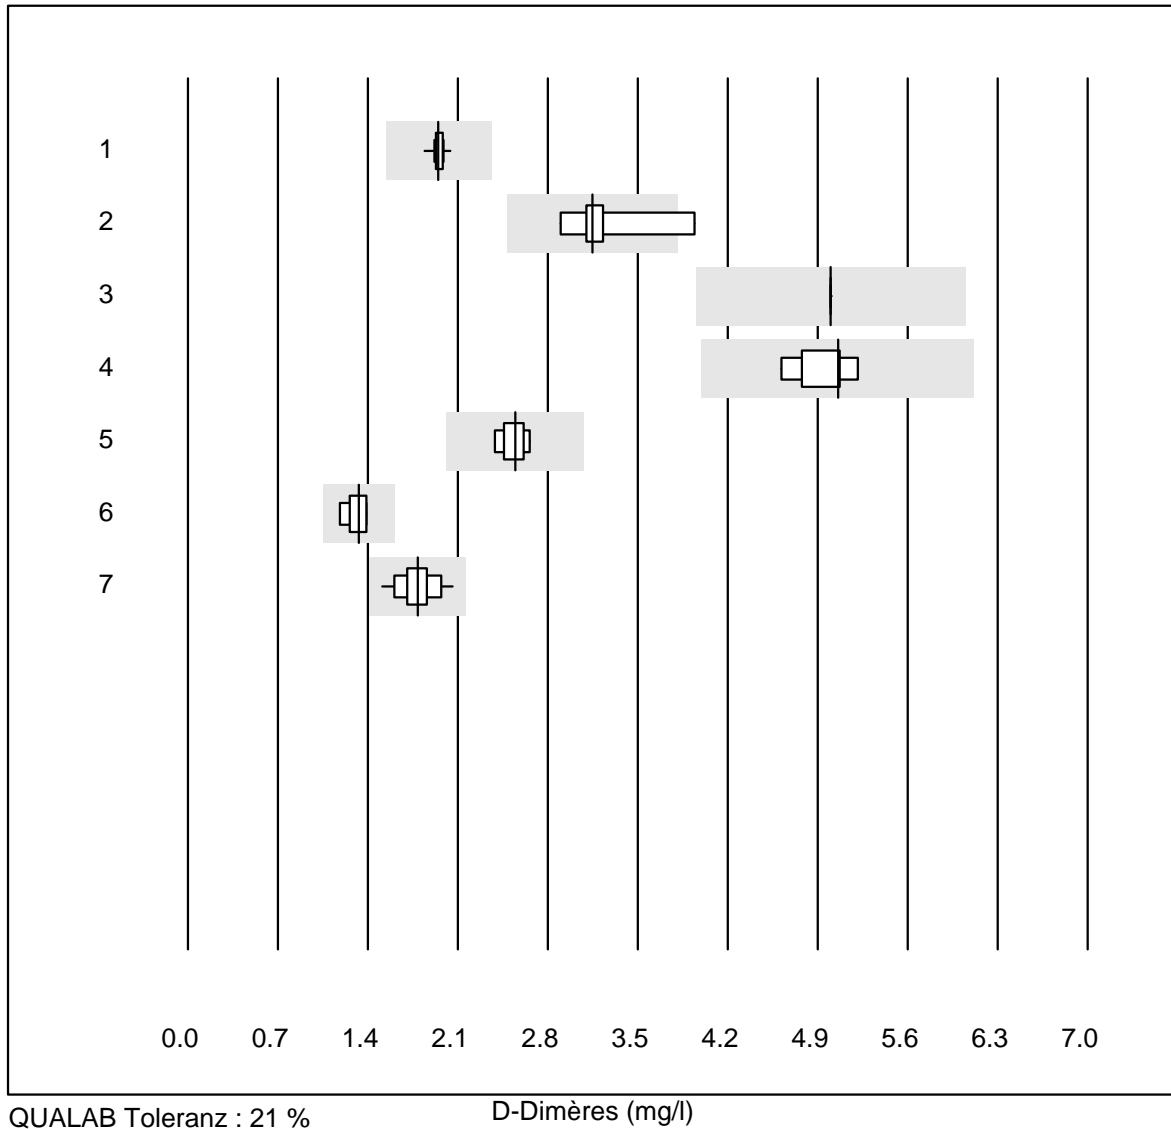


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	STA Liatest	13	100.0	0.0	0.0	1.95	2.5	e
2	Siemens Innovance	6	83.3	16.7	0.0	3.15	11.1	e*
3	Pathfast	5	100.0	0.0	0.0	5.00	0.0	e
4	Eurolyser	6	83.3	0.0	16.7	5.06	4.9	e
5	ACL	8	100.0	0.0	0.0	2.55	3.6	e
6	AQT 90 FLEX	7	100.0	0.0	0.0	1.33	5.9	e
7	VIDAS	20	95.0	0.0	5.0	1.79	7.4	e

CoaguChek APTT

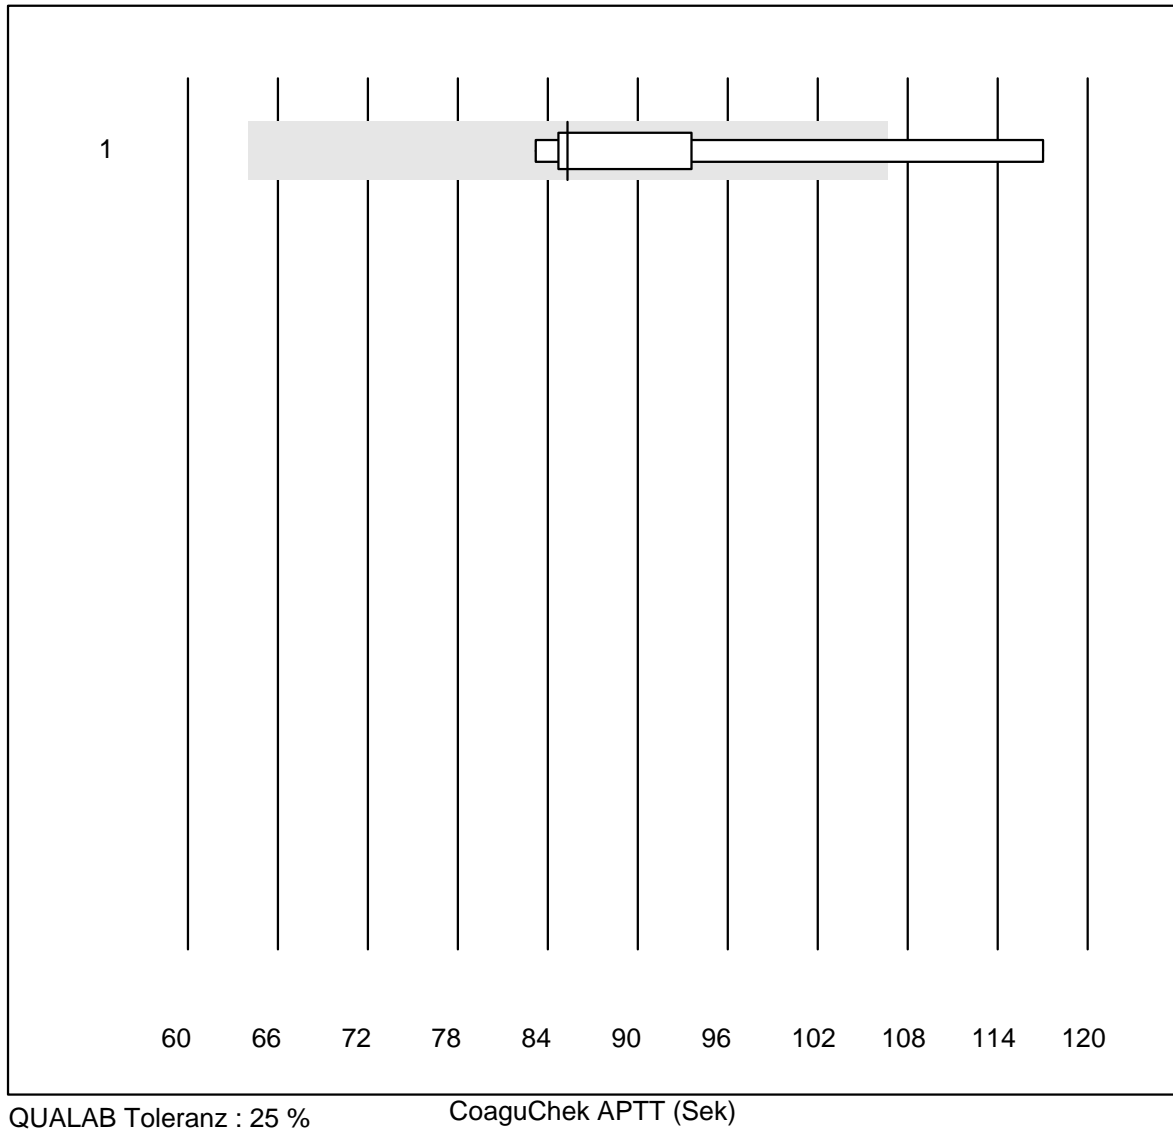


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 CoaguChek Pro II	7	85.7	14.3	0.0	85.3	13.3	e*

INR CCXS

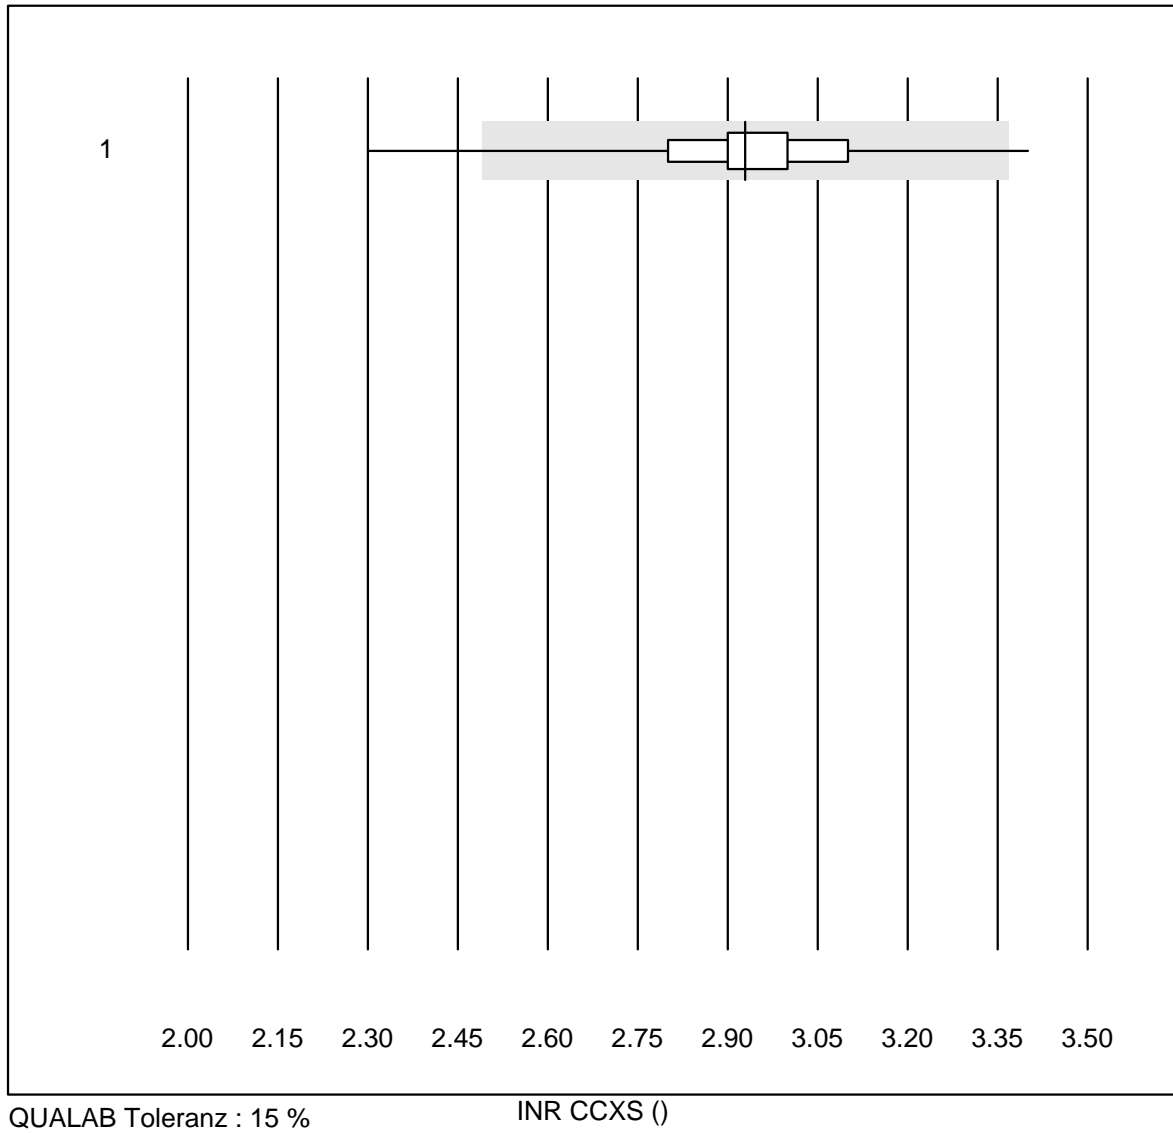

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 CoaguChek XS	1695	99.3	0.3	0.4	2.9	3.6	e

INR HC

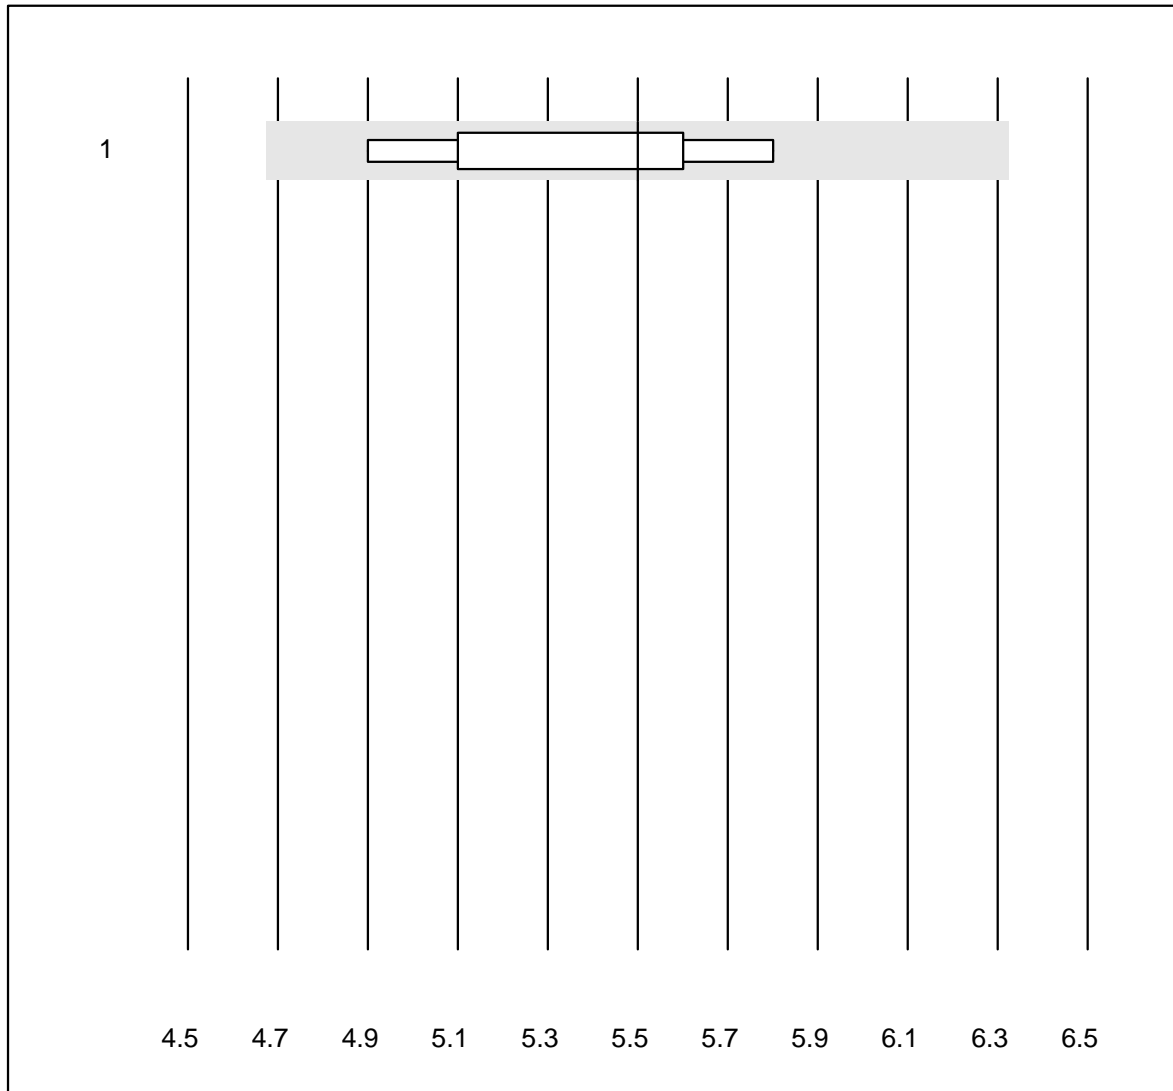


QUALAB Toleranz : 15 %

INR HC ()


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Hemochron j.	7	100.0	0.0	0.0	5.5	5.7	e*

INR MI

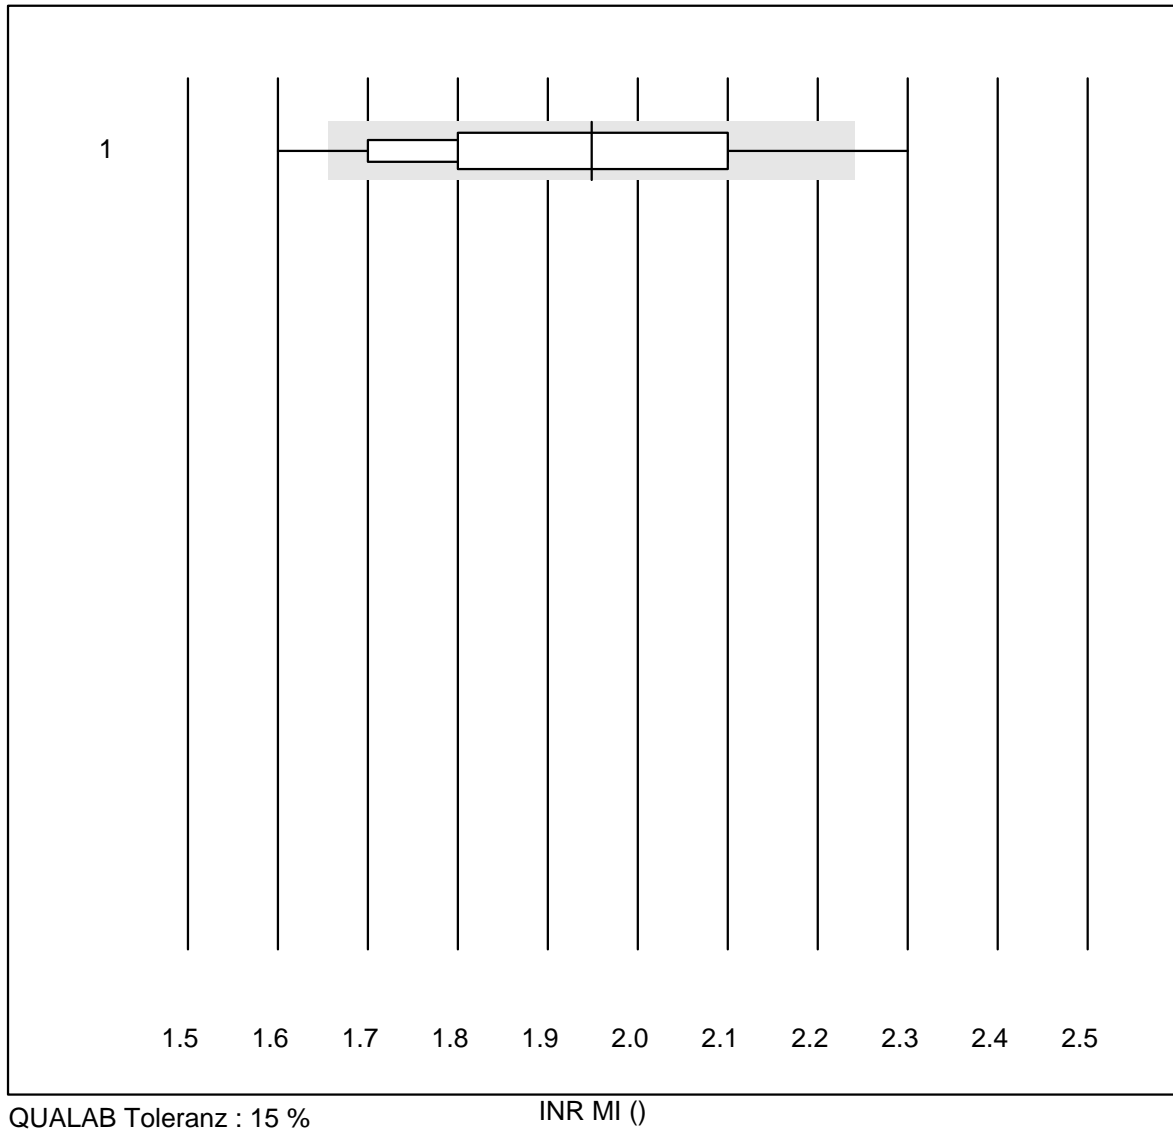


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 MicroINR	126	80.9	4.8	14.3	1.9	8.0	e

INR Xprecia

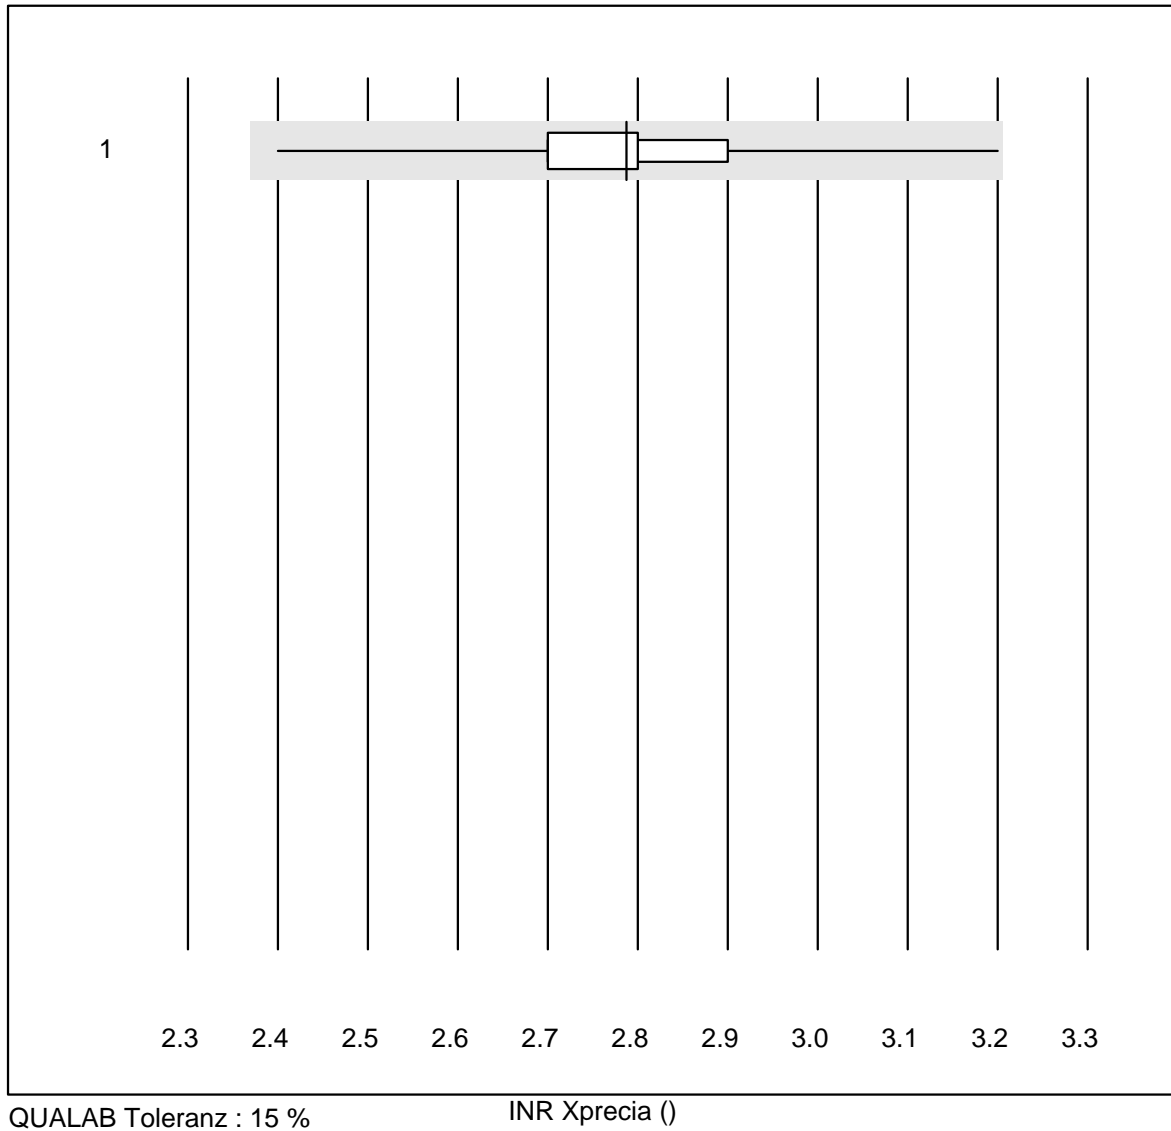

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Xprecia	62	100.0	0.0	0.0	2.8	4.9	e

INR Lumira Dx

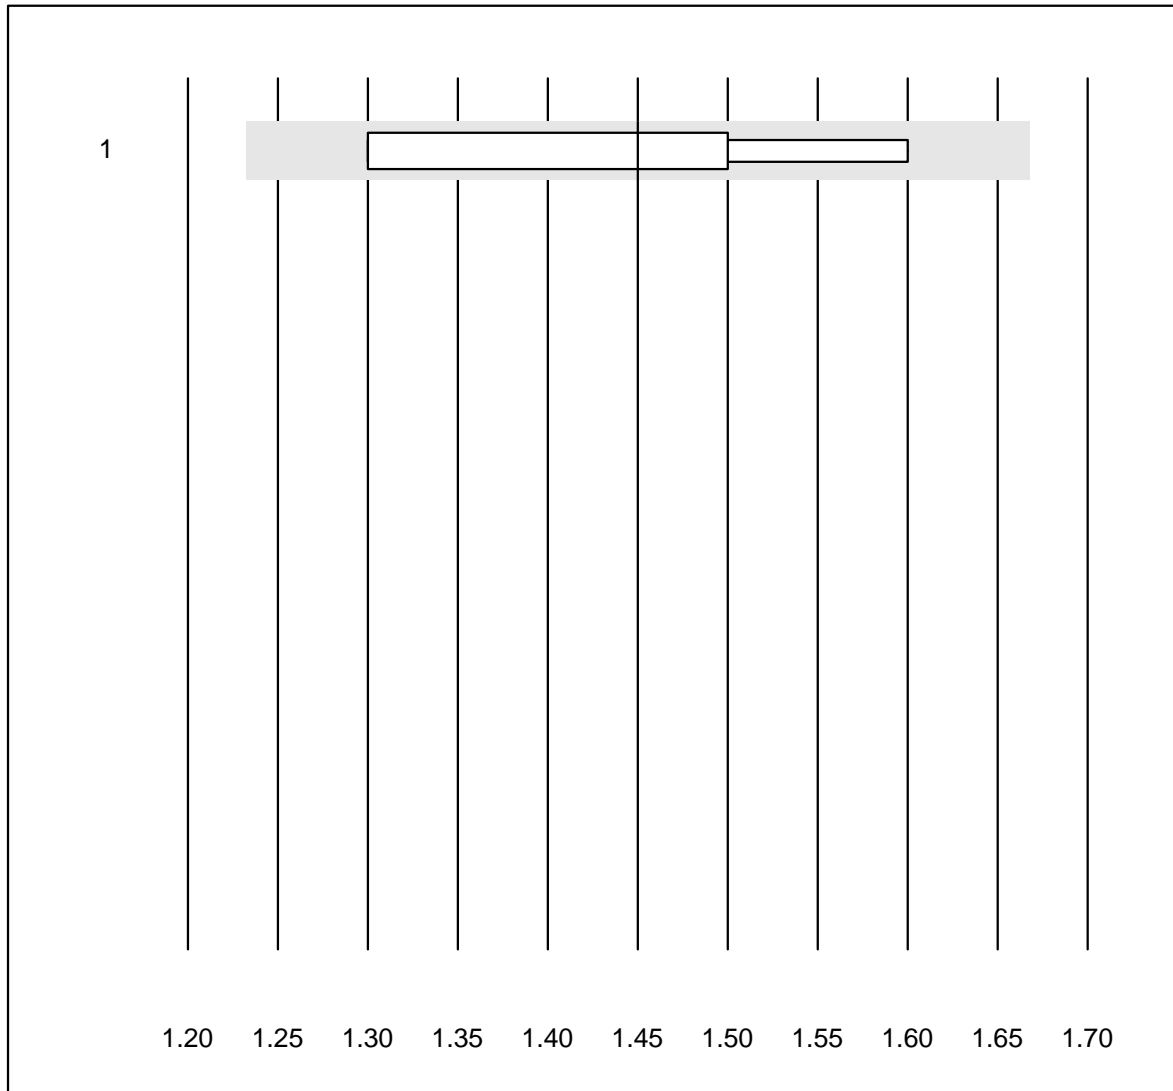


QUALAB Toleranz : 15 %

INR Lumira Dx ()

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Lumira Dx	4	100.0	0.0	0.0	1.5	8.9	e*

Anti-FXa (LMW-Heparin)

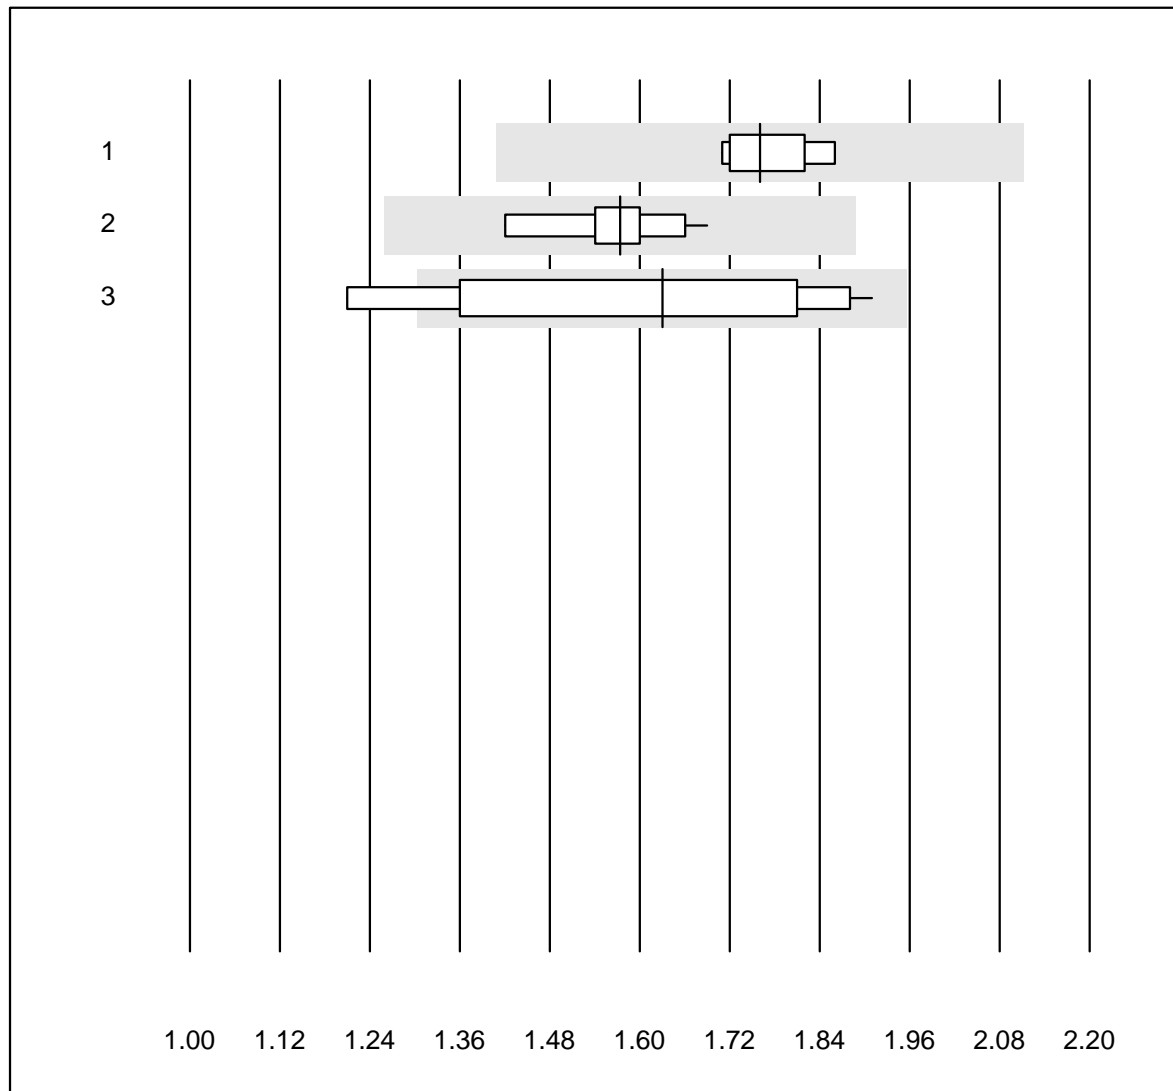


Tolérance MQ : 20 %

Anti-FXa (LMW-Heparin) (IU/ml)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	1.76	3.6	e
2 Stago/STA	10	100.0	0.0	0.0	1.57	4.9	e
3 ACL	10	90.0	10.0	0.0	1.63	16.7	a

Anti-FXa (Rivaroxaban)

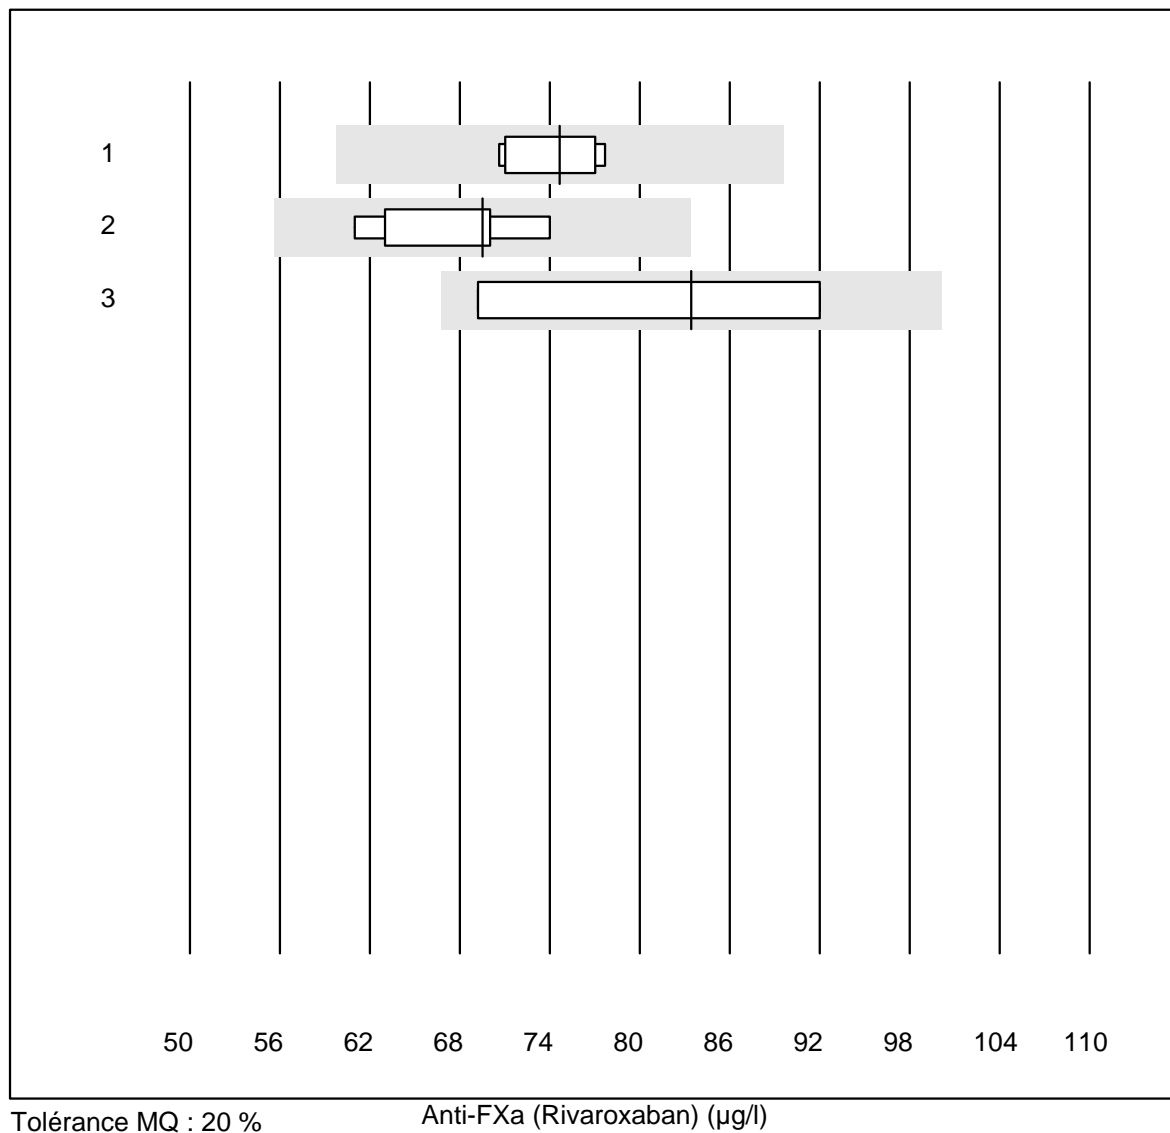


Tolérance MQ : 20 %

Anti-FXa (Rivaroxaban) (µg/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	74.66	3.9	e
2	Stago/STA	8	100.0	0.0	0.0	69.50	6.6	e
3	ACL	4	100.0	0.0	0.0	83.45	14.3	e*

Anti-FXa (Apixaban)

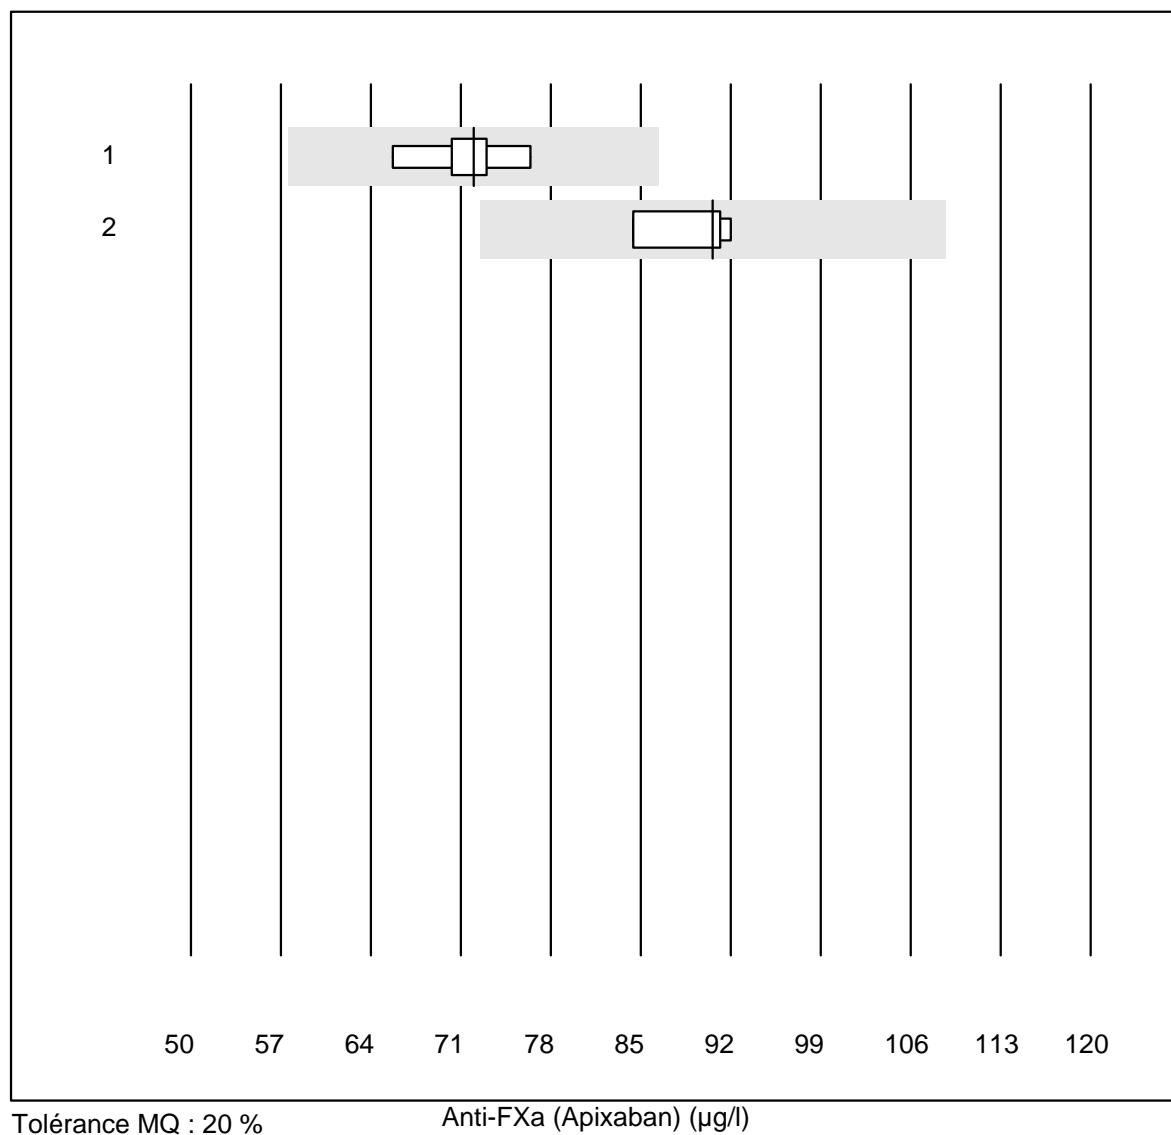


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	72.00	5.5	e*
2	ACL	4	100.0	0.0	0.0	90.60	3.8	e

Hémoglobine

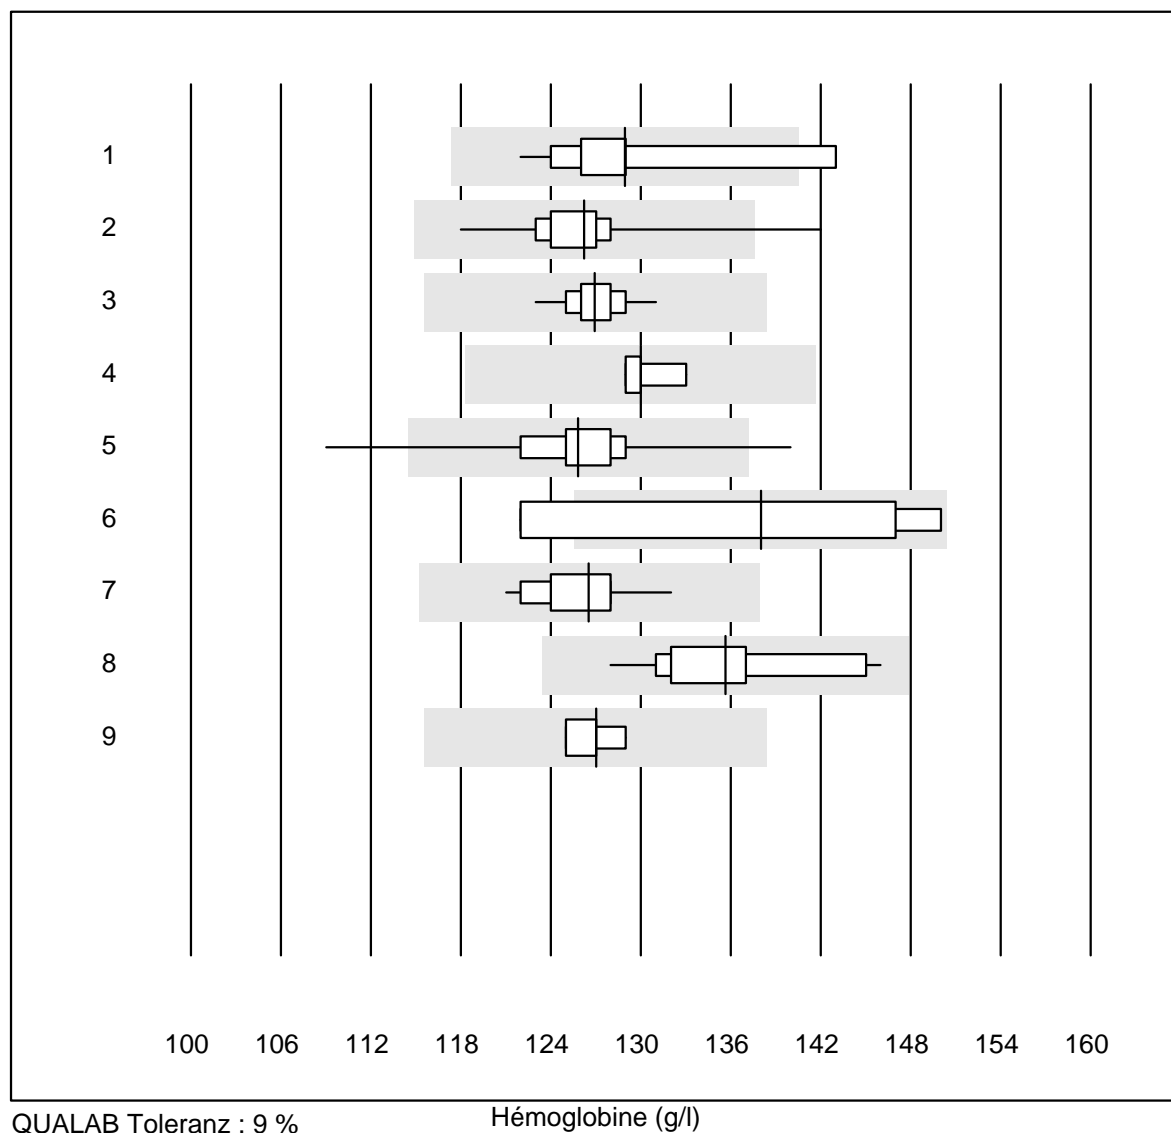


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Automate	16	87.5	12.5	0.0	128.9	4.6	e*
2	Cyanmethémoglobine	22	91.0	4.5	4.5	126.2	4.0	e
3	Sysmex X	45	100.0	0.0	0.0	126.9	1.3	e
4	Advia 120	4	100.0	0.0	0.0	130.0	1.3	e
5	Hemocue	413	93.7	1.9	4.4	125.8	2.6	e
6	Dr. Lange	4	75.0	25.0	0.0	138.0	10.0	e*
7	Hemocontrol	11	100.0	0.0	0.0	126.5	2.5	e
8	DiaSpect	18	88.9	0.0	11.1	135.6	3.7	e
9	Sysmex	8	100.0	0.0	0.0	127.0	1.1	e

Hémoglobine

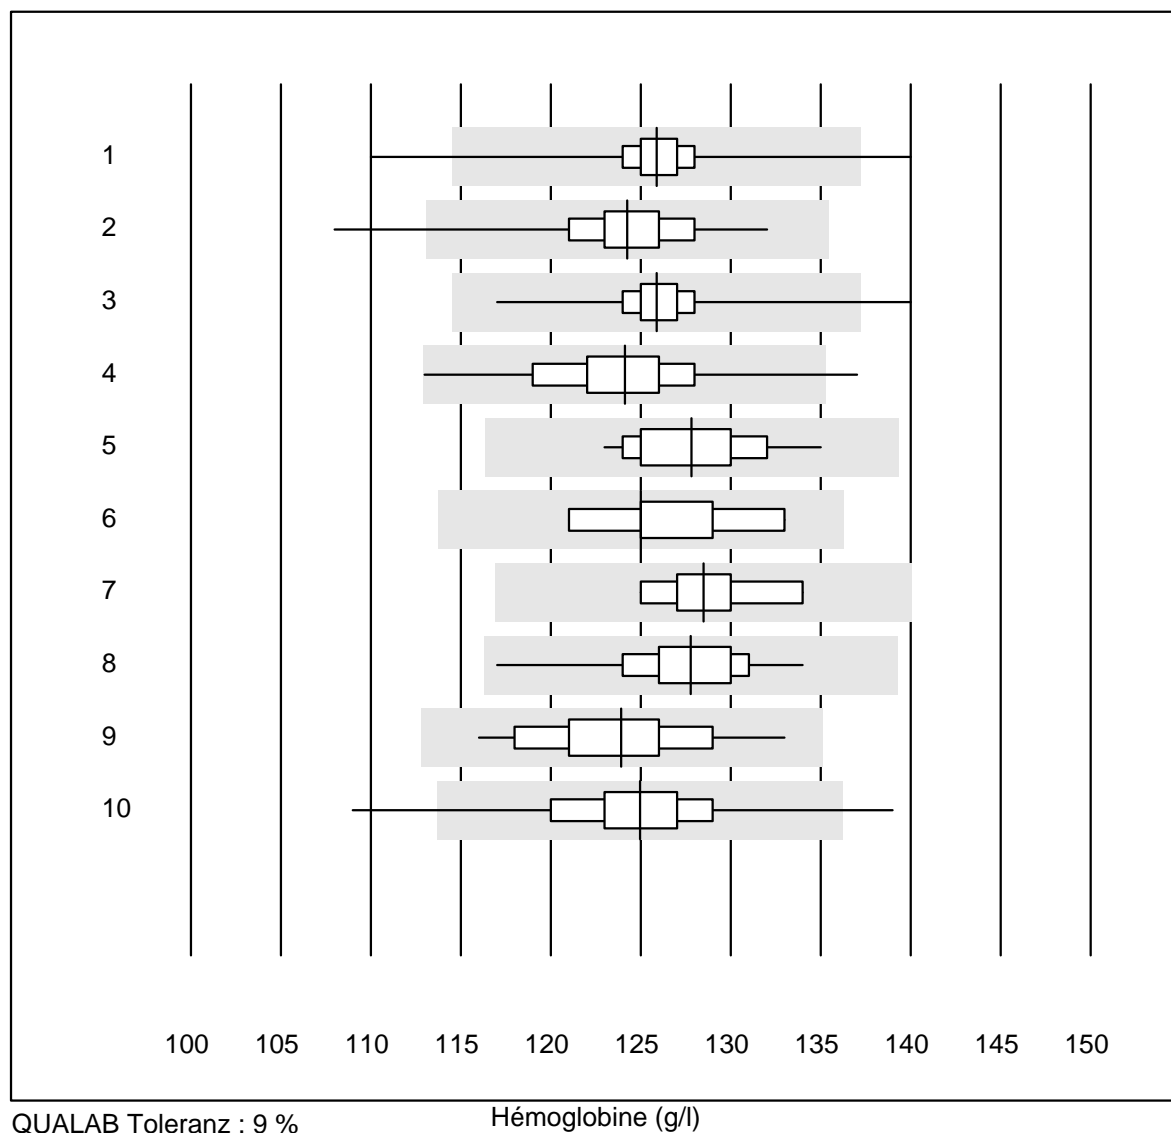

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex KX21	217	96.8	1.4	1.8	125.9	2.1	e
2	Sysmex PochH - 100i	202	96.0	1.0	3.0	124.2	2.5	e
3	Sysmex XP 300	584	97.8	0.5	1.7	125.9	1.7	e
4	Mythic	274	95.2	0.4	4.4	124.1	3.0	e
5	Swelab	33	90.9	0.0	9.1	127.8	2.5	e
6	Abacus Junior	5	100.0	0.0	0.0	125.0	3.6	e*
7	Medonic	6	100.0	0.0	0.0	128.5	2.4	e
8	Celltac Alpha (Nihon	87	94.3	0.0	5.7	127.8	2.3	e
9	Samsung HC10	27	96.3	0.0	3.7	123.9	3.3	e
10	Micros 60	139	93.5	2.9	3.6	125.0	3.4	e

Hématocrite

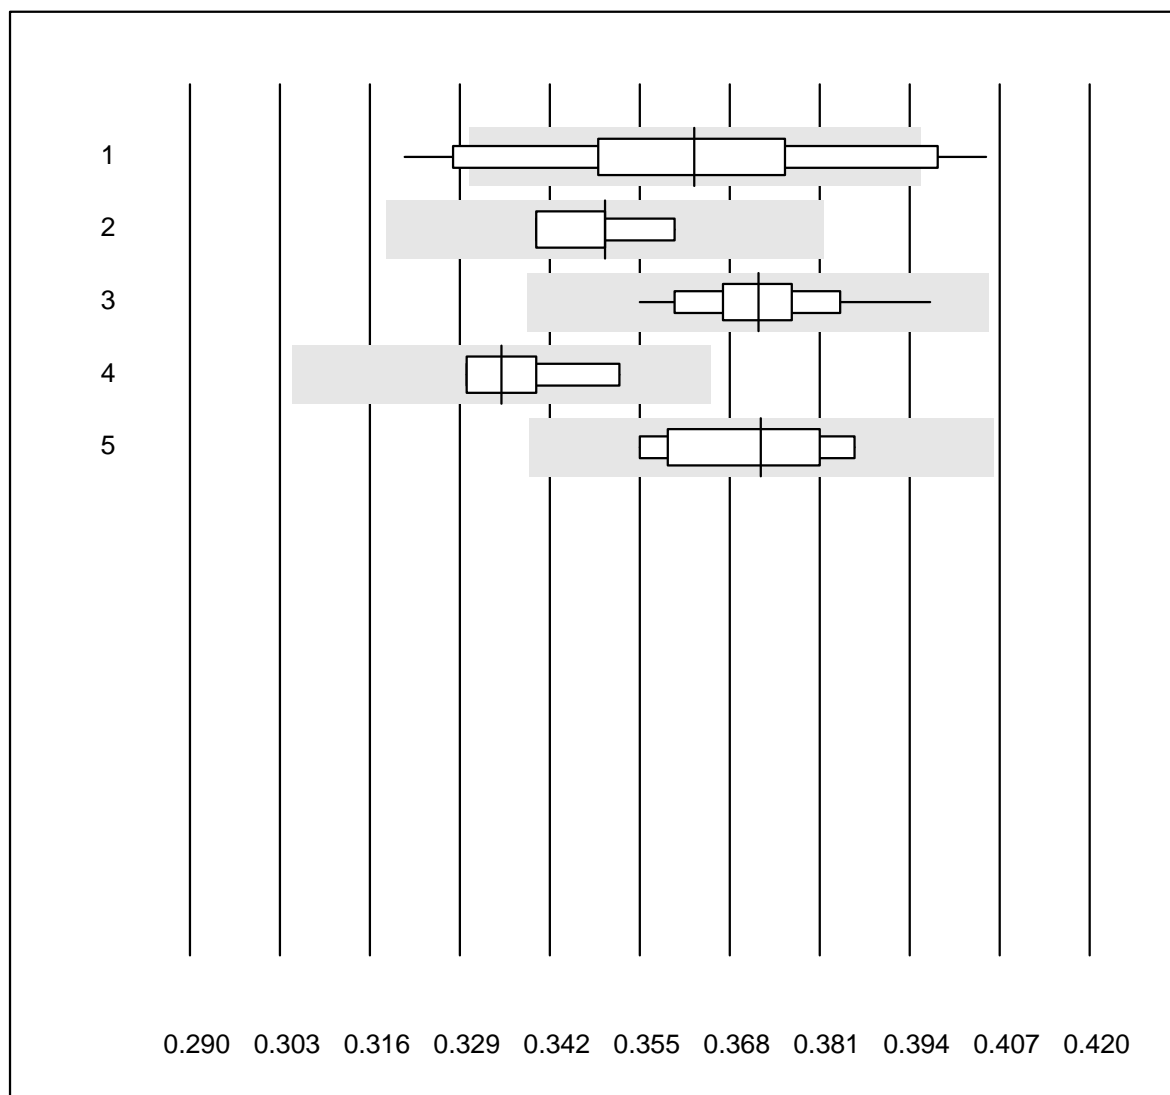


QUALAB Toleranz : 9 %

Hématocrite (l/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Automate	14	64.3	35.7	0.0	0.36	6.9	e*
2	Centrifuge	4	100.0	0.0	0.0	0.35	2.3	e*
3	Sysmex X	45	97.8	0.0	2.2	0.37	2.4	e
4	Advia 120	4	100.0	0.0	0.0	0.34	3.1	e*
5	Sysmex	8	100.0	0.0	0.0	0.37	3.5	e*

Hématocrite

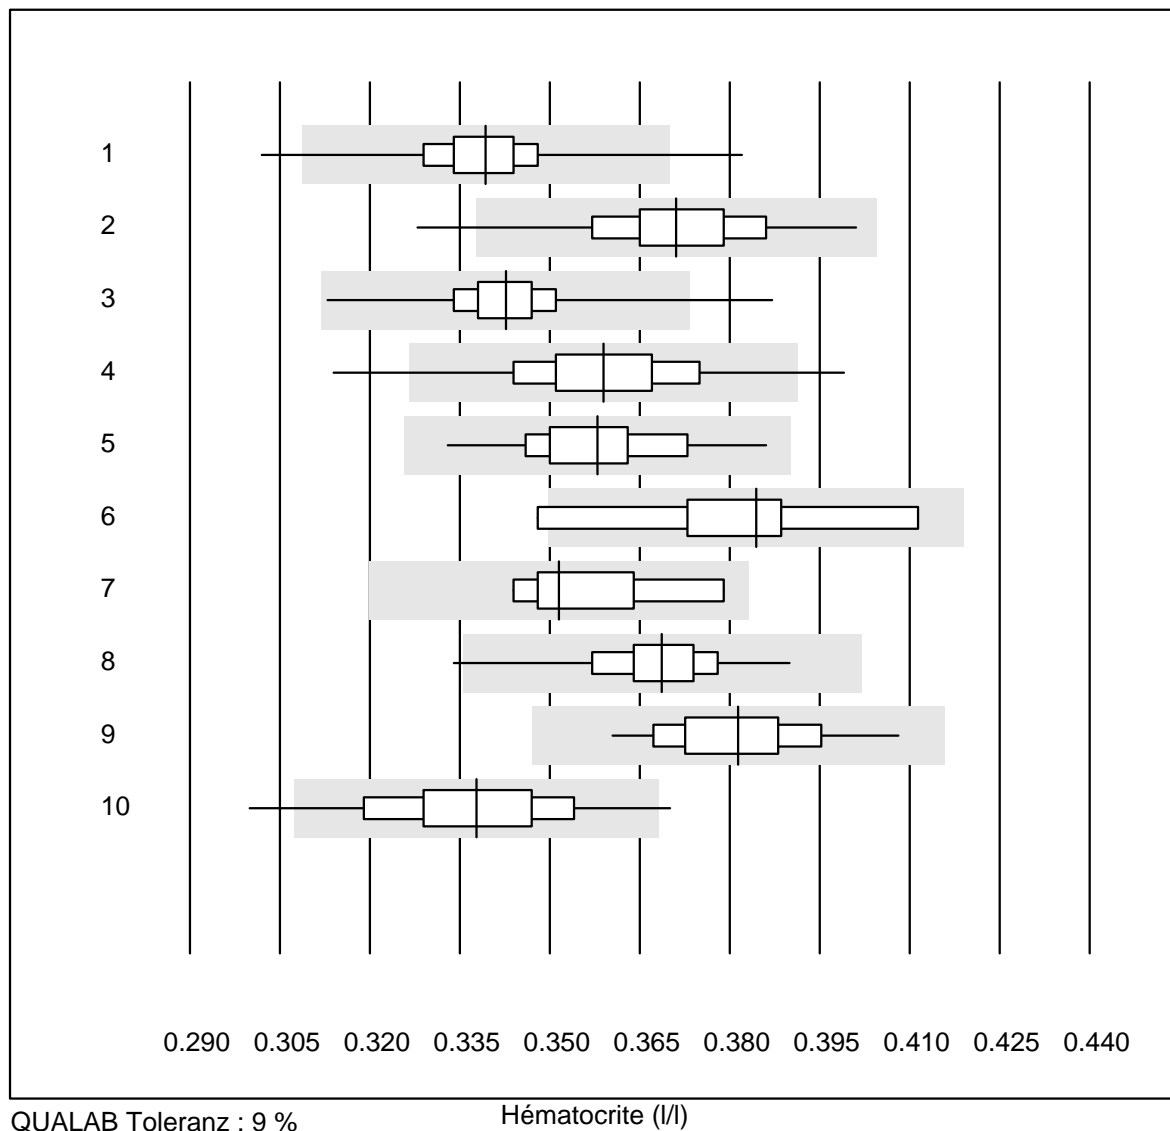

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex KX21	217	97.3	0.9	1.8	0.34	2.7	e
2	Sysmex PochH - 100i	203	94.6	2.0	3.4	0.37	3.5	e
3	Sysmex XP 300	585	97.4	0.7	1.9	0.34	2.2	e
4	Mythic	276	93.5	2.2	4.3	0.36	3.5	e
5	Swelab	33	90.9	0.0	9.1	0.36	3.1	e
6	Abacus Junior	5	80.0	20.0	0.0	0.38	6.1	e*
7	Medonic	6	100.0	0.0	0.0	0.35	3.6	e*
8	Celltac Alpha (Nihon	88	93.2	1.1	5.7	0.37	2.5	e
9	Samsung HC10	27	96.3	0.0	3.7	0.38	2.9	e
10	Micros 60	139	87.8	3.6	8.6	0.34	4.1	e

Erythrocytes

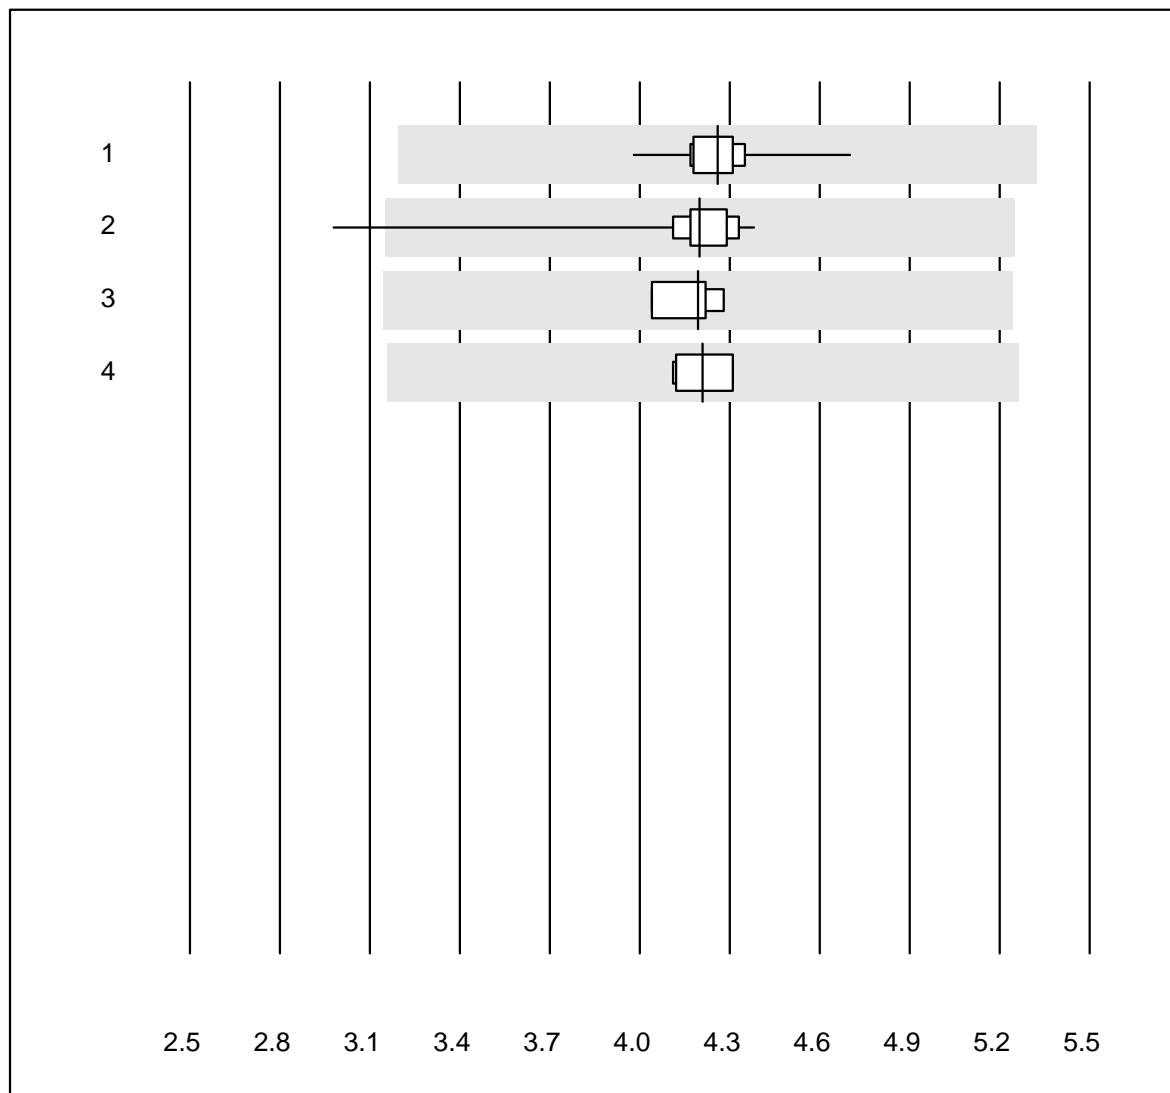


QUALAB Toleranz : 25 %

Erythrocytes (T/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Automate	13	100.0	0.0	0.0	4.26	3.8	e
2 Sysmex X	45	97.8	2.2	0.0	4.20	4.8	e
3 Advia 120	4	100.0	0.0	0.0	4.20	2.4	e
4 Sysmex	8	100.0	0.0	0.0	4.21	2.0	e

Erythrocytes

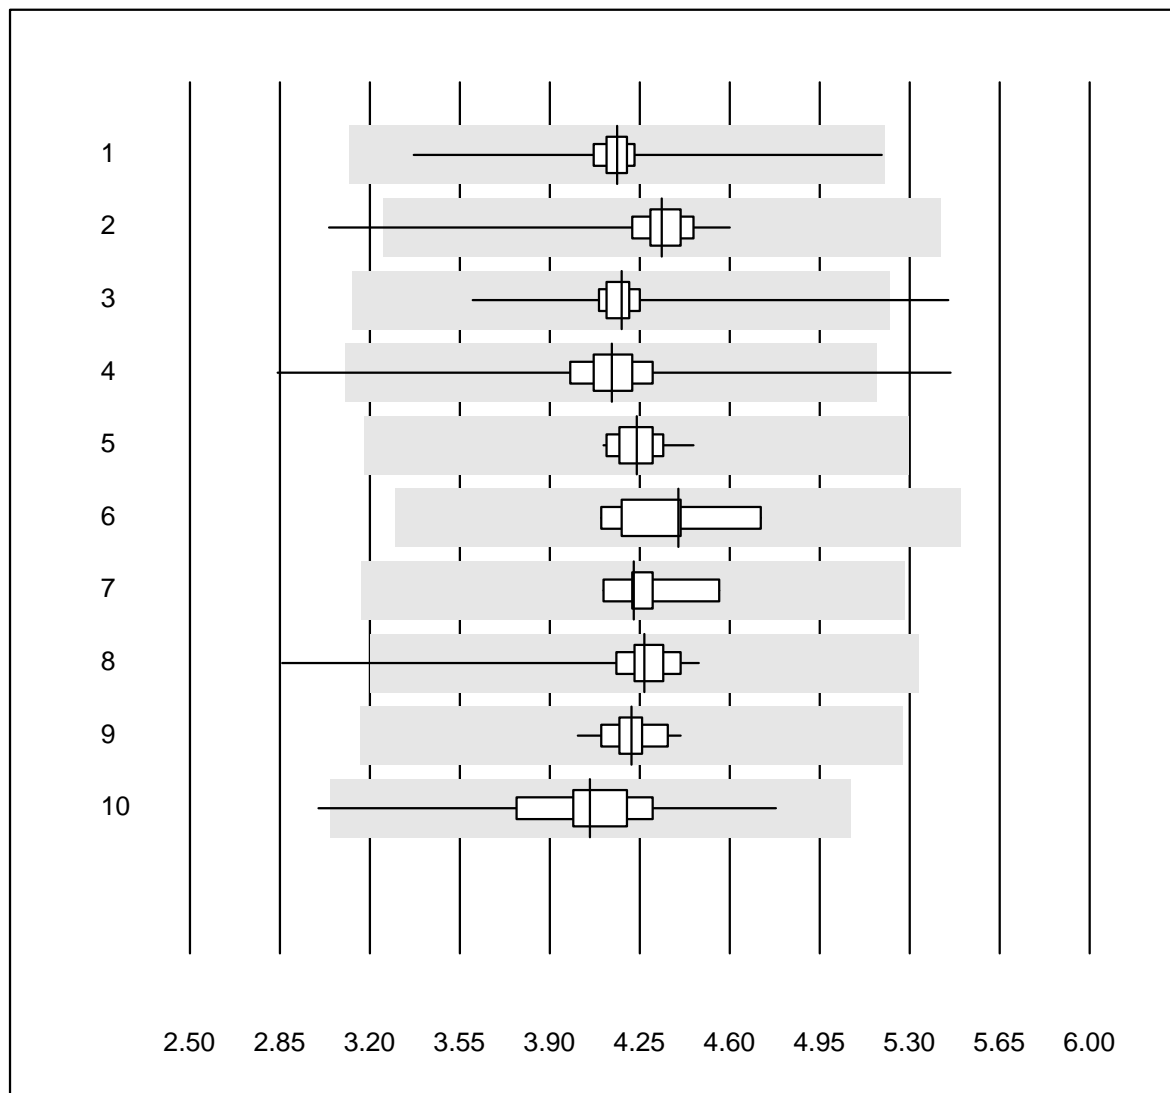


QUALAB Toleranz : 25 %

Erythrocytes (T/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex KX21	217	99.1	0.0	0.9	4.16	3.1	e
2	Sysmex PochH - 100i	203	97.0	1.0	2.0	4.34	3.8	e
3	Sysmex XP 300	586	99.0	0.5	0.5	4.18	3.1	e
4	Mythic	276	97.1	1.1	1.8	4.14	5.0	e
5	Swelab	33	90.9	0.0	9.1	4.24	2.1	e
6	Abacus Junior	5	100.0	0.0	0.0	4.40	5.5	e
7	Medonic	6	100.0	0.0	0.0	4.23	3.6	e
8	Celltac Alpha (Nihon	88	94.4	1.1	4.5	4.27	4.2	e
9	Samsung HC10	27	96.3	0.0	3.7	4.22	2.2	e
10	Micros 60	139	95.7	0.7	3.6	4.06	6.5	e

Leucocytes

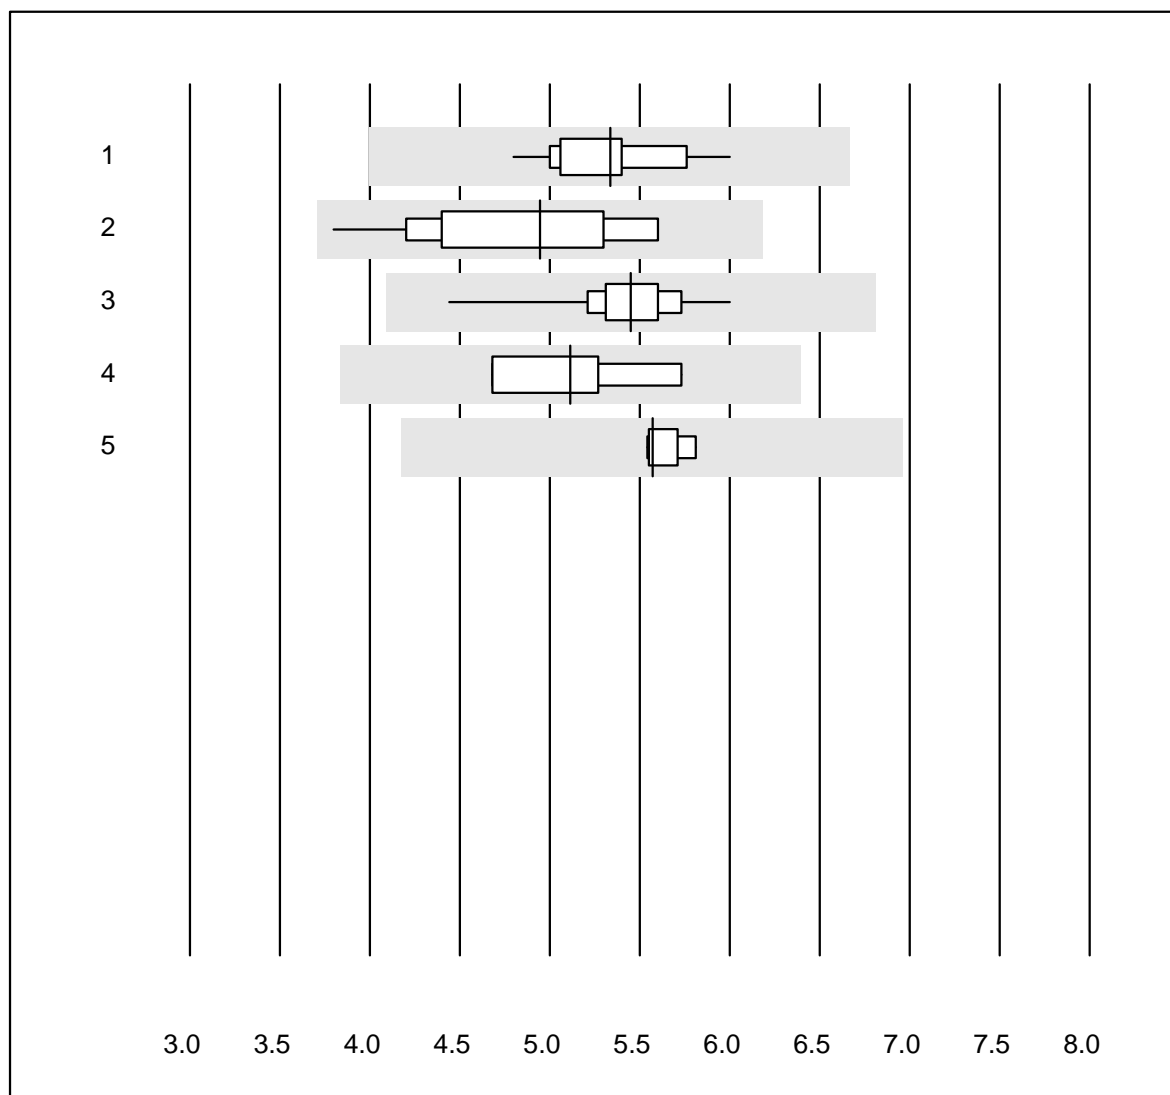


QUALAB Toleranz : 25 %

Leucocytes (G/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Automate	12	100.0	0.0	0.0	5.34	6.5	e
2	Microscopie	15	93.3	0.0	6.7	4.95	11.3	e
3	Sysmex X	45	97.8	0.0	2.2	5.45	5.2	e
4	Advia 120 (Perox)	4	100.0	0.0	0.0	5.12	8.7	e*
5	Sysmex	8	87.5	0.0	12.5	5.57	1.8	e

Leucocytes

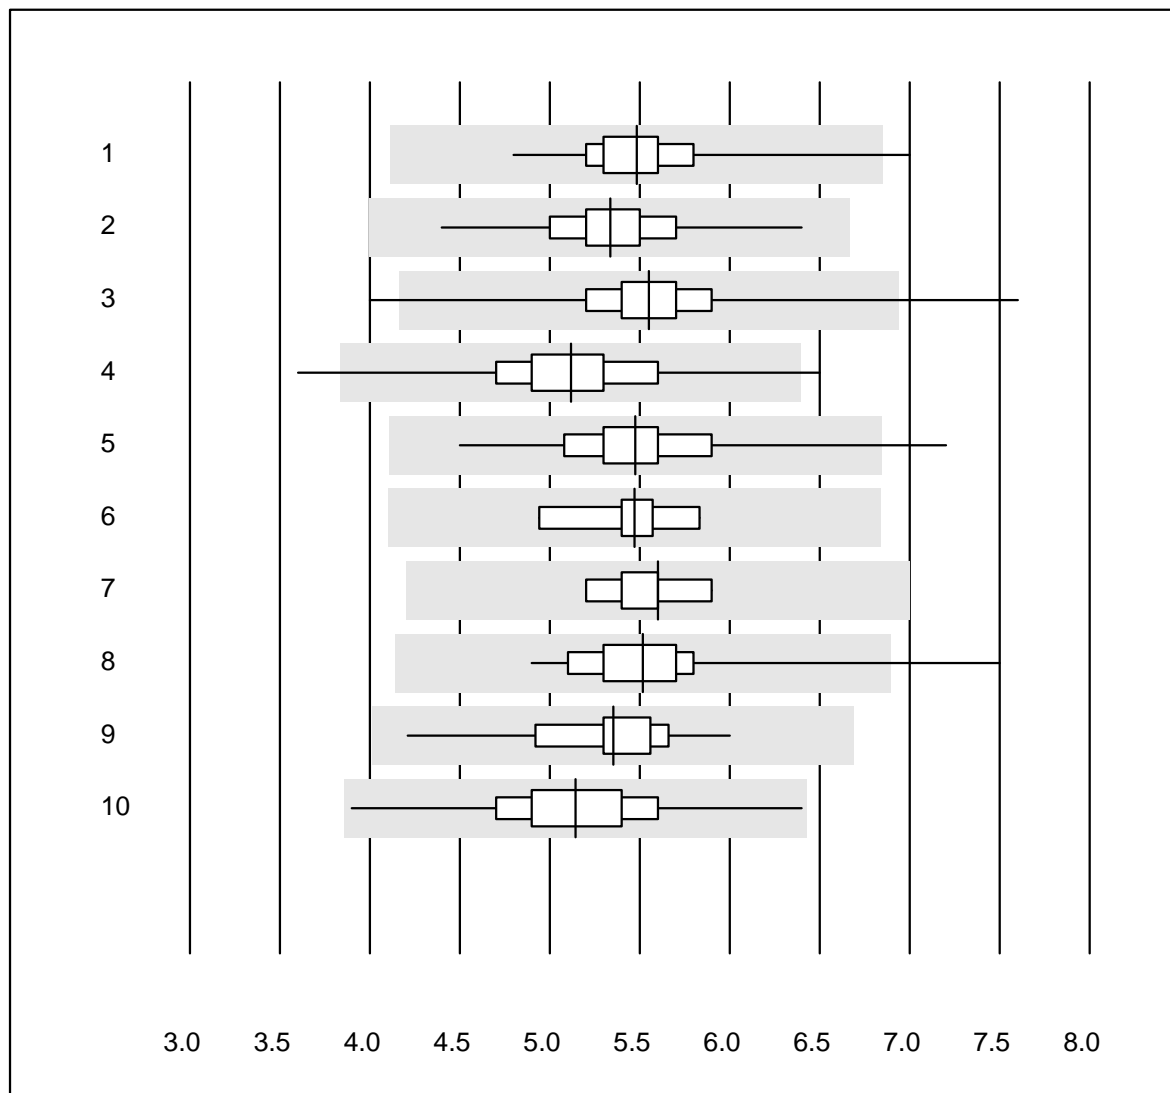


QUALAB Toleranz : 25 %

Leucocytes (G/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex KX21	216	97.7	0.9	1.4	5.48	5.6	e
2	Sysmex PochH - 100i	203	98.5	0.0	1.5	5.34	5.3	e
3	Sysmex XP 300	586	97.6	1.7	0.7	5.55	6.4	e
4	Mythic	274	97.1	2.2	0.7	5.12	7.5	e
5	Swelab	33	97.0	3.0	0.0	5.48	8.2	e
6	Abacus Junior	5	100.0	0.0	0.0	5.47	6.0	e
7	Medonic	6	100.0	0.0	0.0	5.60	4.2	e
8	Celltac Alpha (Nihon	88	96.6	1.1	2.3	5.52	6.8	e
9	Samsung HC10	27	92.6	0.0	7.4	5.35	6.5	e
10	Micros 60	139	97.8	0.0	2.2	5.14	7.4	e

Thrombocytes

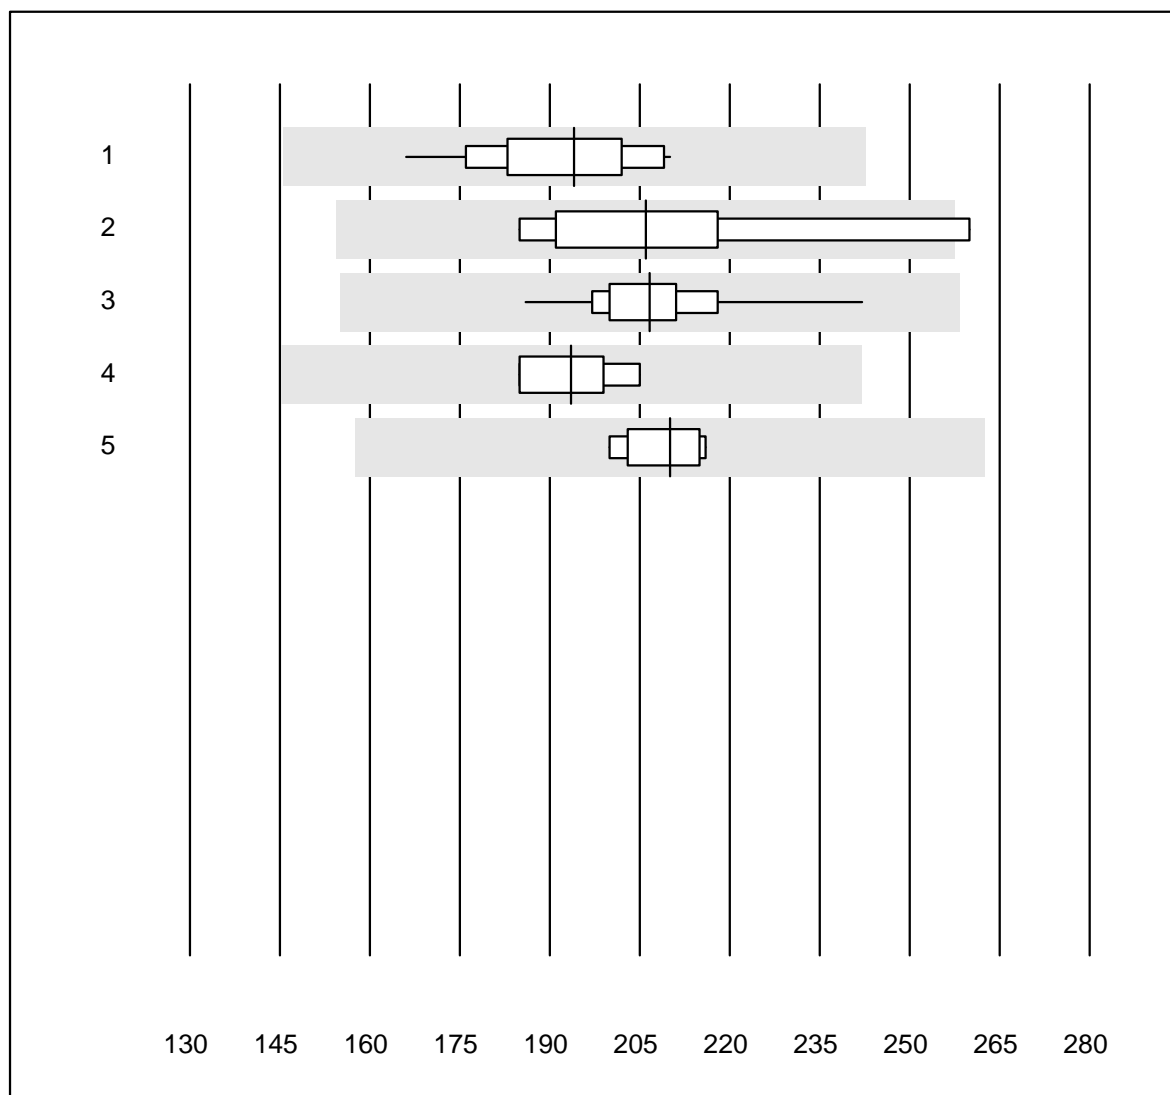


QUALAB Toleranz : 25 %

Thrombocytes (G/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Automate	12	100.0	0.0	0.0	194.1	7.2	e
2	Microscopie	8	87.5	12.5	0.0	206.0	11.1	e*
3	Sysmex X	45	100.0	0.0	0.0	206.6	4.7	e
4	Advia 120	4	100.0	0.0	0.0	193.5	4.8	e
5	Sysmex	8	100.0	0.0	0.0	210.0	2.9	e

Thrombocytes

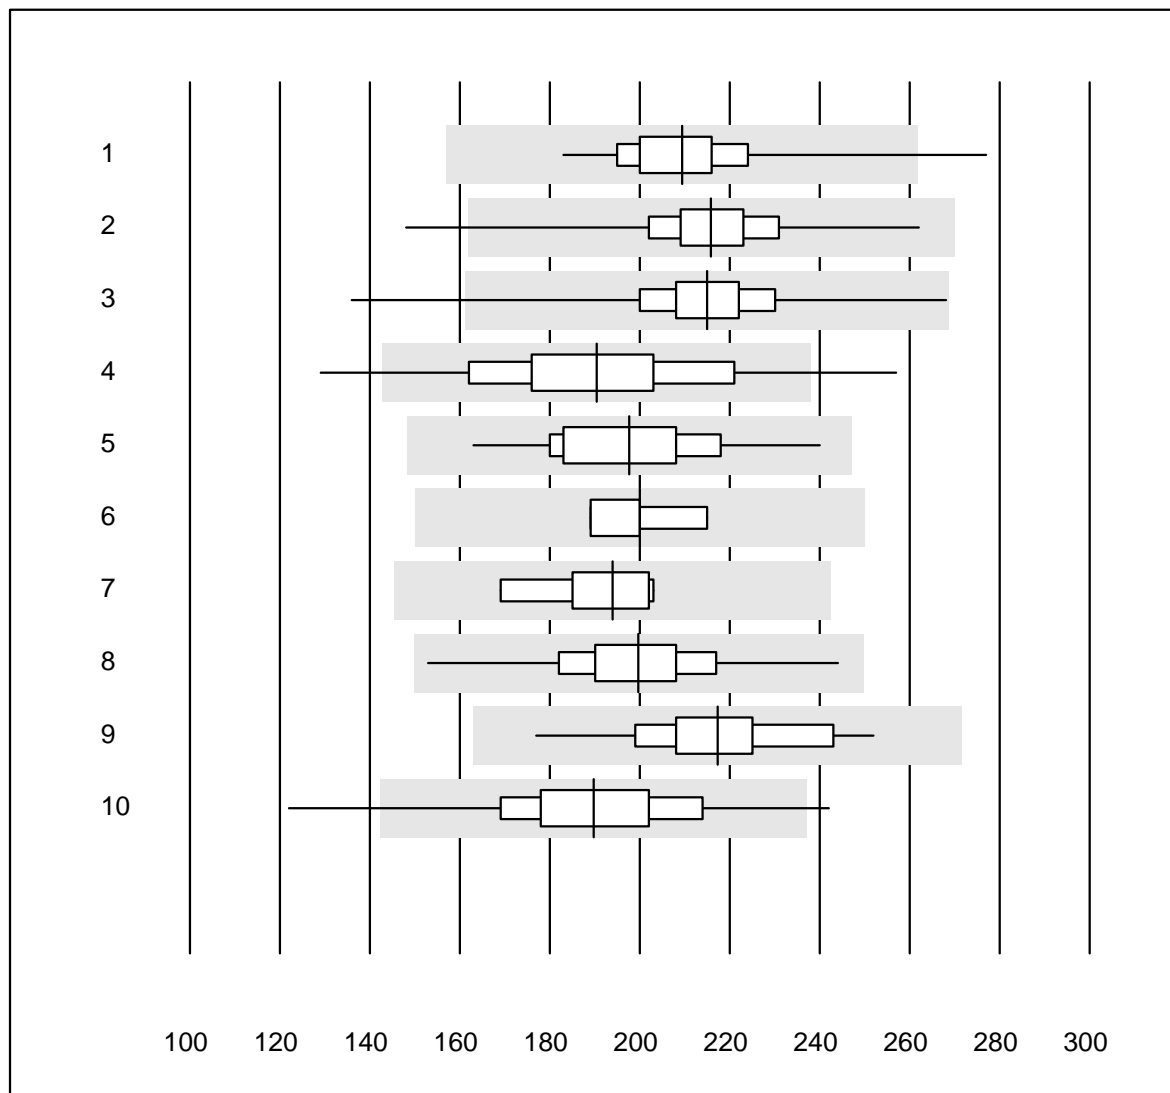


QUALAB Toleranz : 25 %

Thrombocytes (G/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex KX21	216	98.6	0.5	0.9	209.4	6.0	e
2	Sysmex PochH - 100i	203	98.0	1.0	1.0	215.9	6.3	e
3	Sysmex XP 300	586	99.1	0.2	0.7	215.0	6.1	e
4	Mythic	275	95.7	2.5	1.8	190.3	11.4	e
5	Swelab	33	97.0	0.0	3.0	197.7	8.9	e
6	Abacus Junior	5	80.0	0.0	20.0	200.0	5.3	e
7	Medonic	6	100.0	0.0	0.0	194.0	6.8	e
8	Celltac Alpha (Nihon	88	98.9	0.0	1.1	199.7	8.0	e
9	Samsung HC10	27	96.3	0.0	3.7	217.3	7.8	e
10	Micros 60	139	92.1	3.6	4.3	189.7	10.1	e

Hémoglobine H2

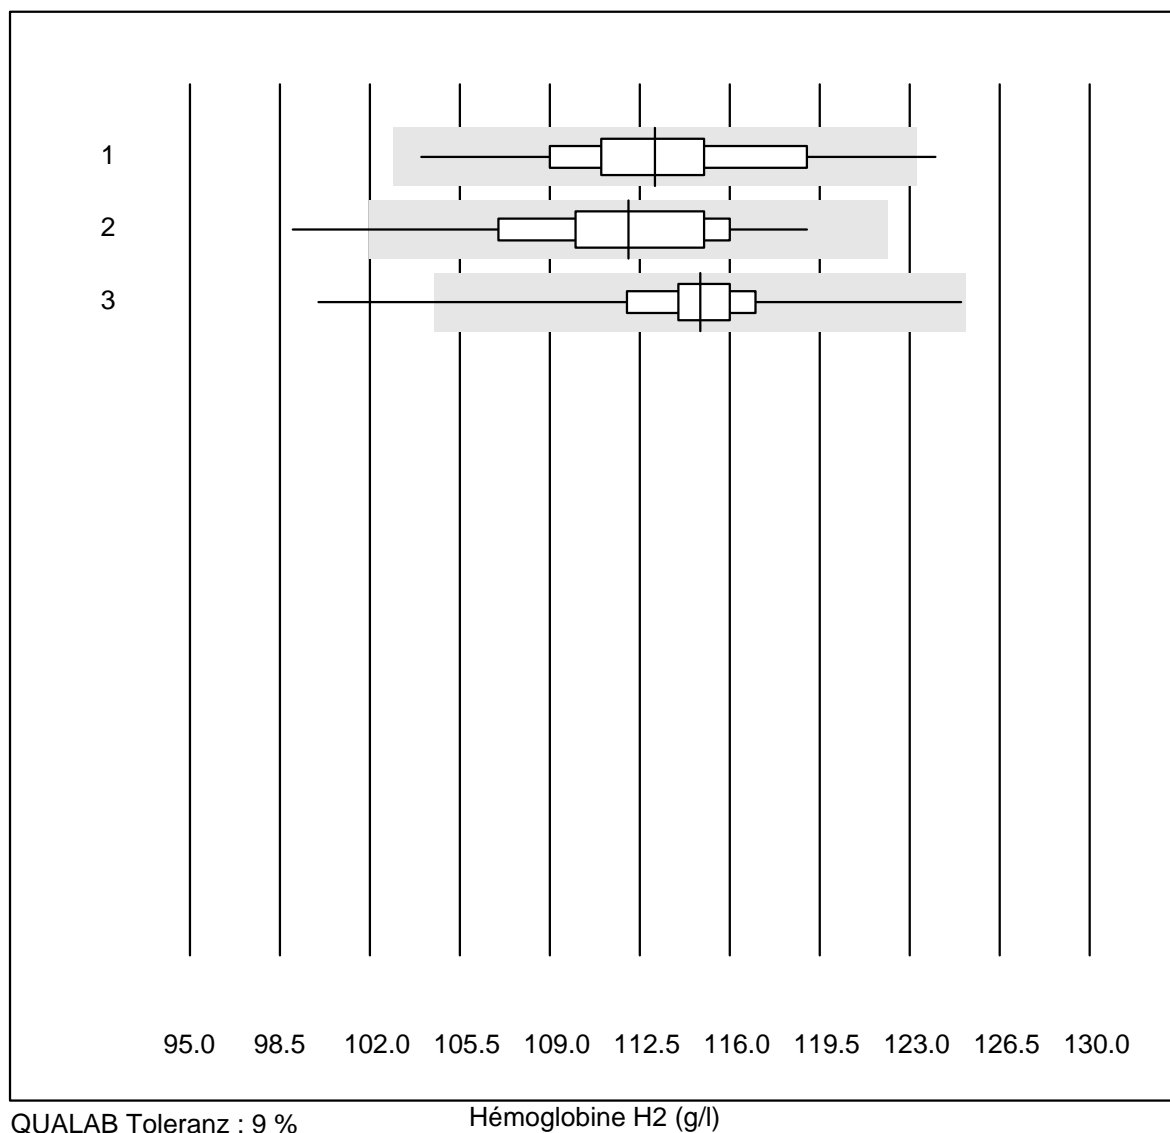

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Z3	81	96.3	1.2	2.5	113.1	3.3	e
2 Abx Micros	118	97.5	0.8	1.7	112.1	3.5	e
3 Microsemi	792	96.1	0.9	3.0	114.8	2.1	e

Hématocrite H2

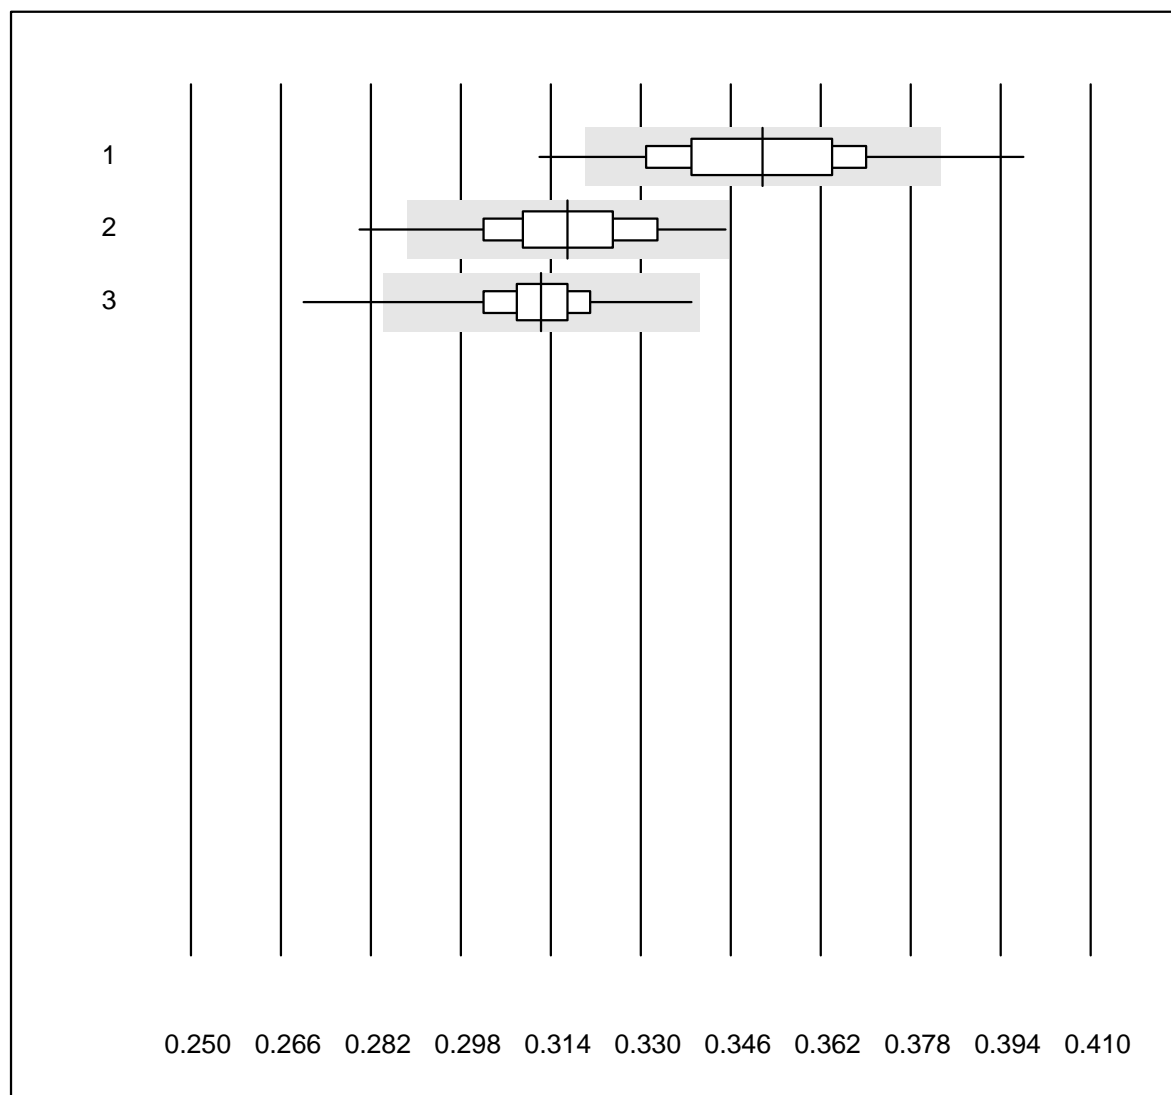


QUALAB Toleranz : 9 %

Hématocrite H2 (l/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Z3	81	92.6	4.9	2.5	0.35	4.6	e
2 Abx Micros	118	95.8	0.8	3.4	0.32	3.8	e
3 Microsemi	792	94.4	1.4	4.2	0.31	2.8	e

Leucocytes H2

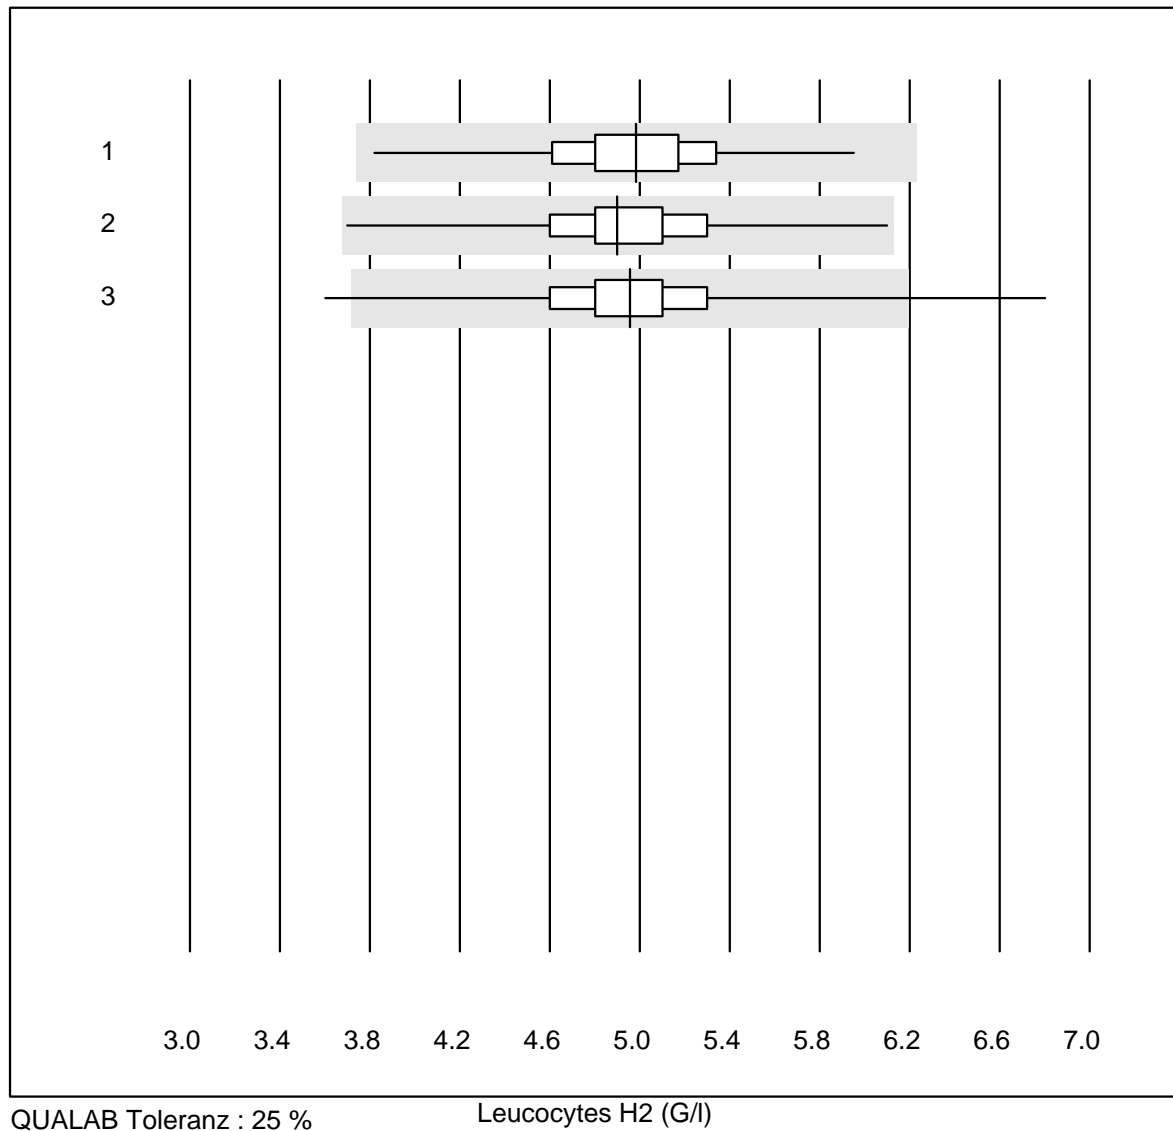

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Z3	81	100.0	0.0	0.0	4.98	6.5	e
2 Abx Micros	118	96.6	0.0	3.4	4.90	6.9	e
3 Microsemi	792	97.8	0.9	1.3	4.96	6.3	e

Thrombocytes H2

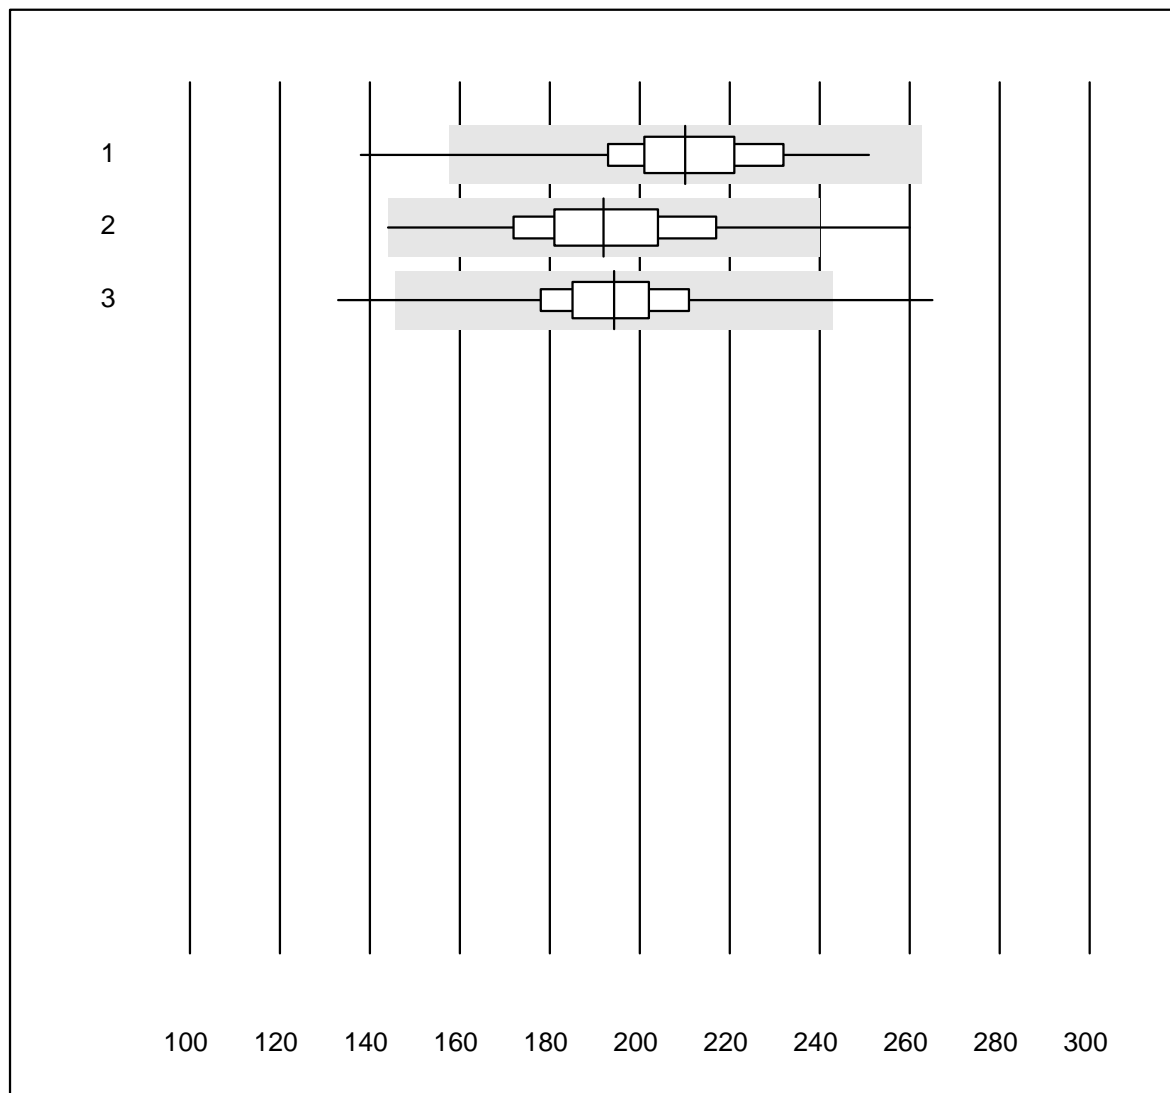


QUALAB Toleranz : 25 %

Thrombocytes H2 (G/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Z3	81	95.1	1.2	3.7	210.2	7.7	e
2 Abx Micros	118	88.1	5.1	6.8	192.0	10.4	e
3 Microsemi	791	96.9	1.0	2.1	194.3	7.7	e

Erythrocytes H2

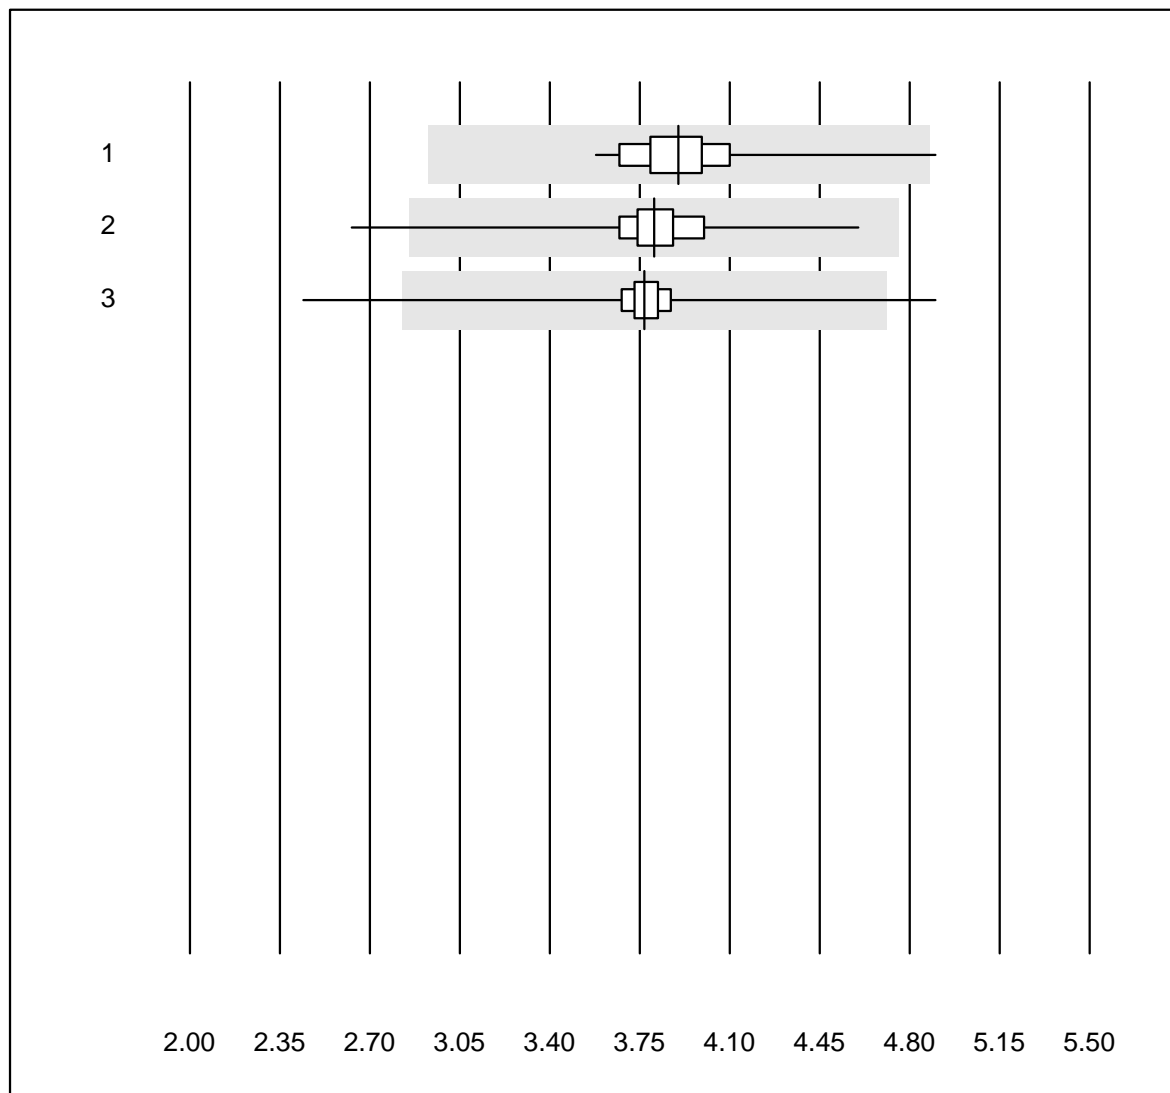


QUALAB Toleranz : 25 %

Erythrocytes H2 (T/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Z3	81	97.6	1.2	1.2	3.90	4.9	e
2 Abx Micros	118	97.5	0.8	1.7	3.81	5.4	e
3 Microsemi	792	97.0	1.0	2.0	3.77	4.3	e

CRP H2

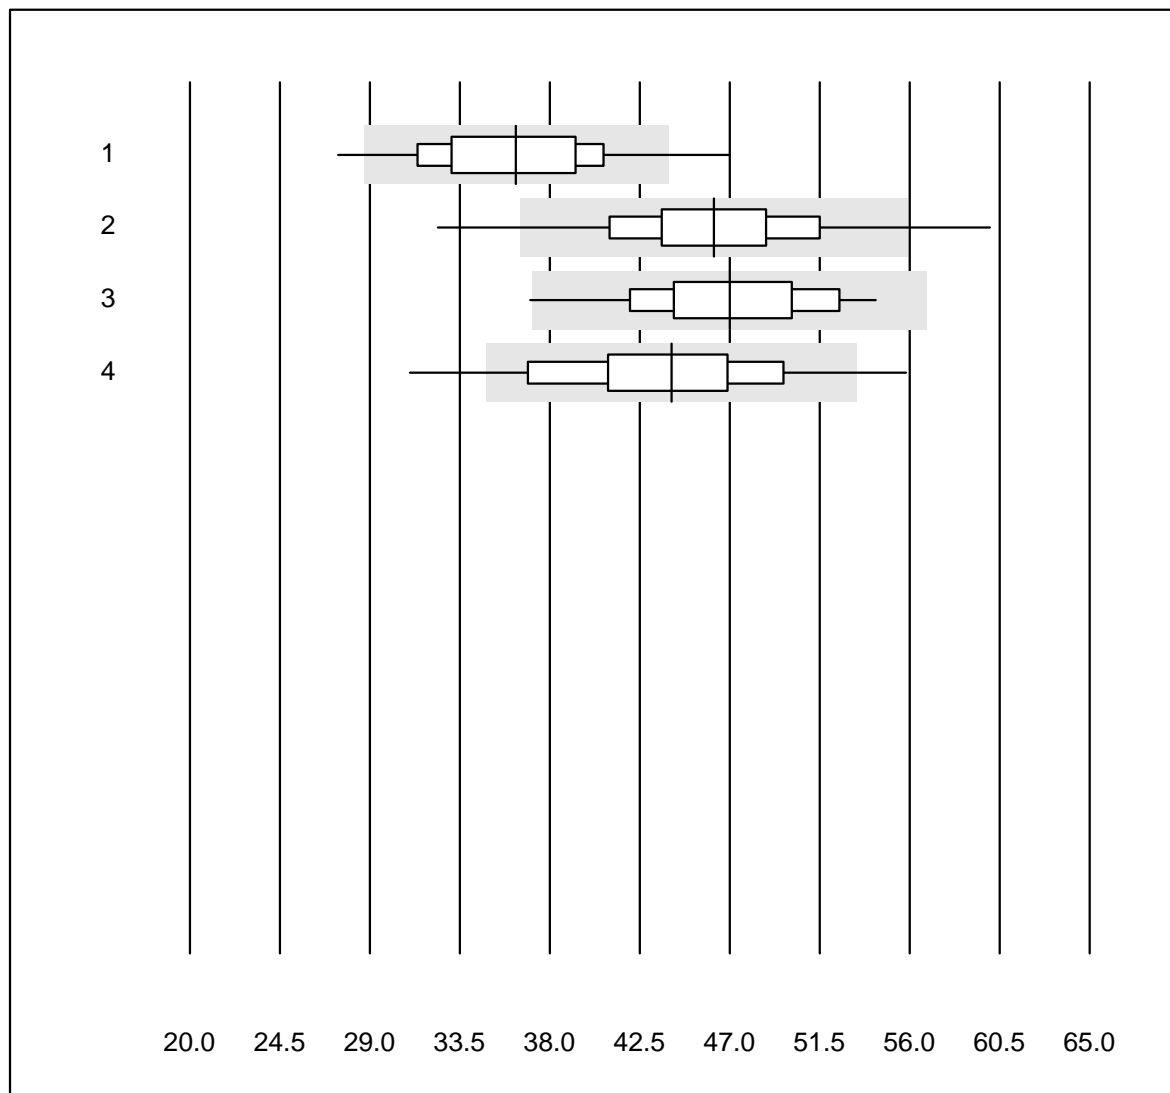


QUALAB Toleranz : 21 %

CRP H2 (mg/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Z3	73	91.8	5.5	2.7	36.3	11.1	e
2 Microsemi	780	96.2	2.8	1.0	46.2	9.1	e
3 Abx Micros	15	93.3	6.7	0.0	47.0	9.6	e
4 ABX Micros CRP200	100	94.0	5.0	1.0	44.1	10.9	e

Hémoglobine BG

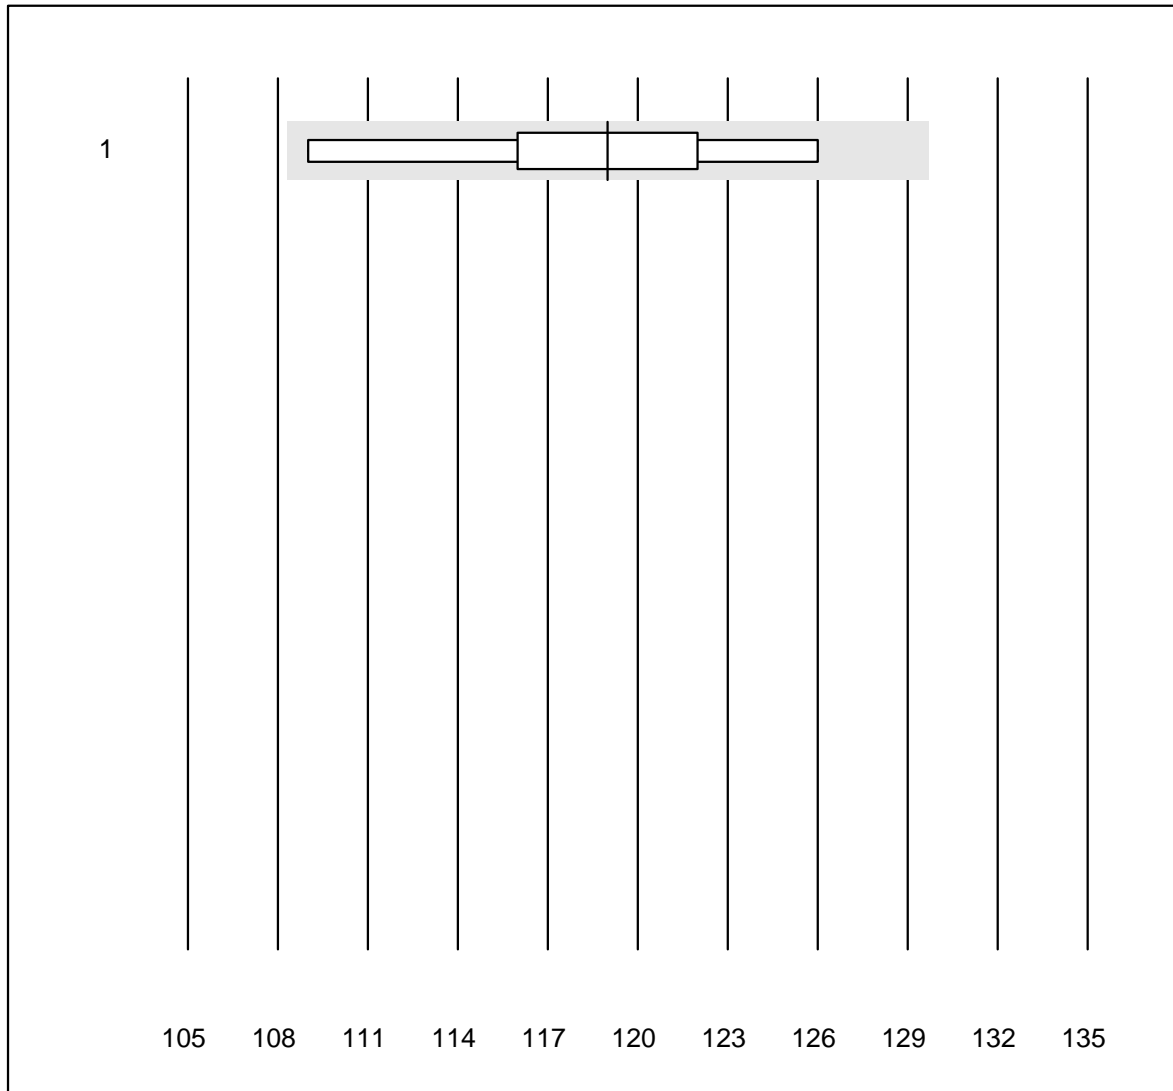


QUALAB Toleranz : 9 %

Hémoglobine BG (g/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 iStat	6	100.0	0.0	0.0	119.0	5.1	e*

Hématocrite

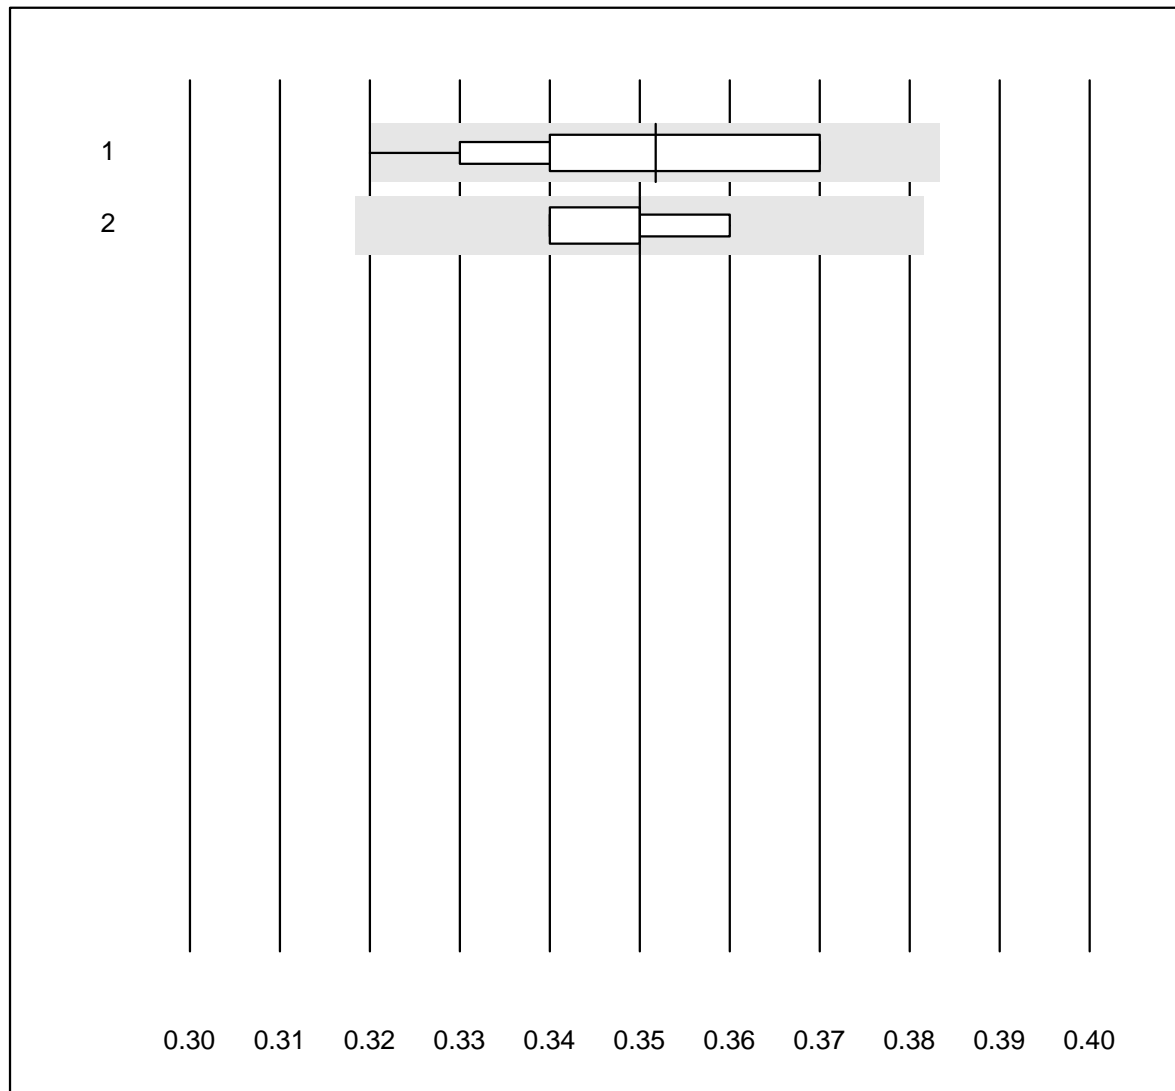


QUALAB Toleranz : 9 %

Hématocrite (l/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 iStat	11	90.9	9.1	0.0	0.35	4.9	e*
2 EPOC	7	100.0	0.0	0.0	0.35	2.0	e

Hémoglobine

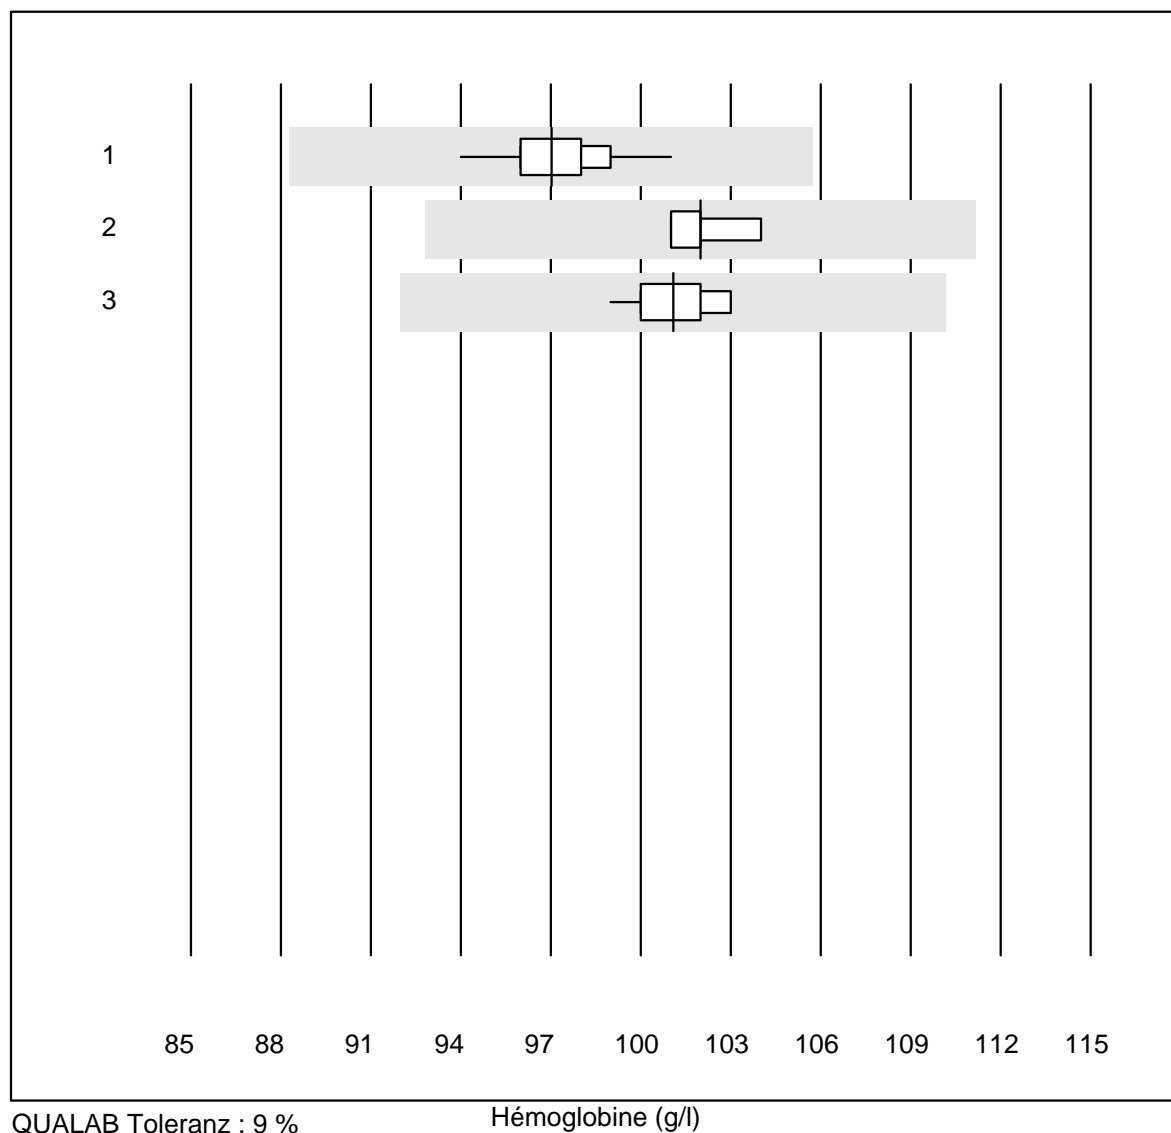

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	74	98.6	0.0	1.4	97.0	1.2	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	102.0	1.2	e
3 Yumizen/Pentra	17	100.0	0.0	0.0	101.1	1.1	e

Hématocrite

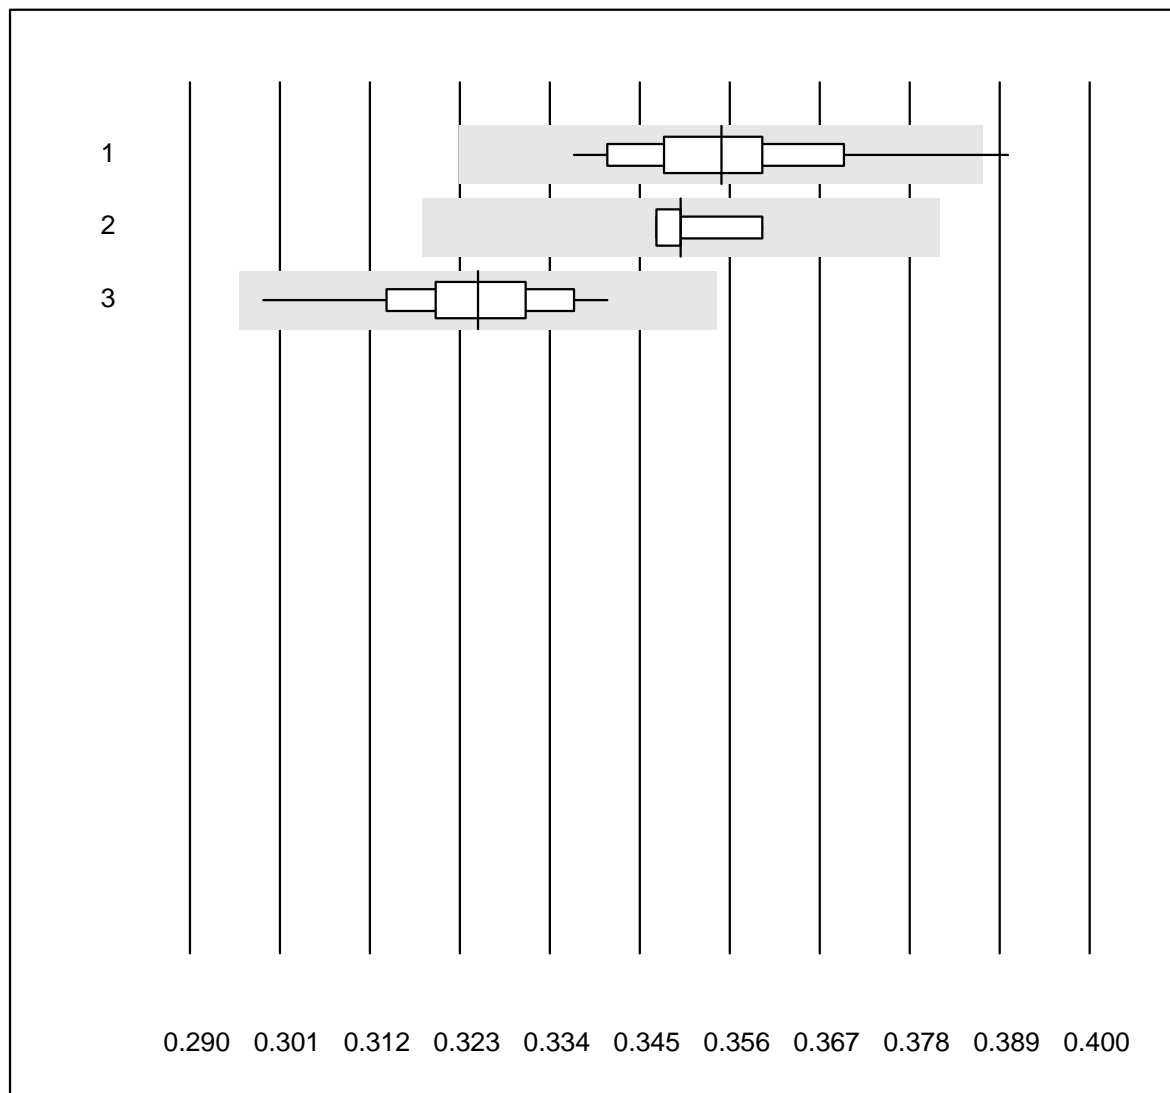


QUALAB Toleranz : 9 %

Hématocrite (l/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	74	97.2	1.4	1.4	0.36	3.2	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	0.35	1.6	e
3 Yumizen/Pentra	17	100.0	0.0	0.0	0.33	3.1	e

Erythrocytes

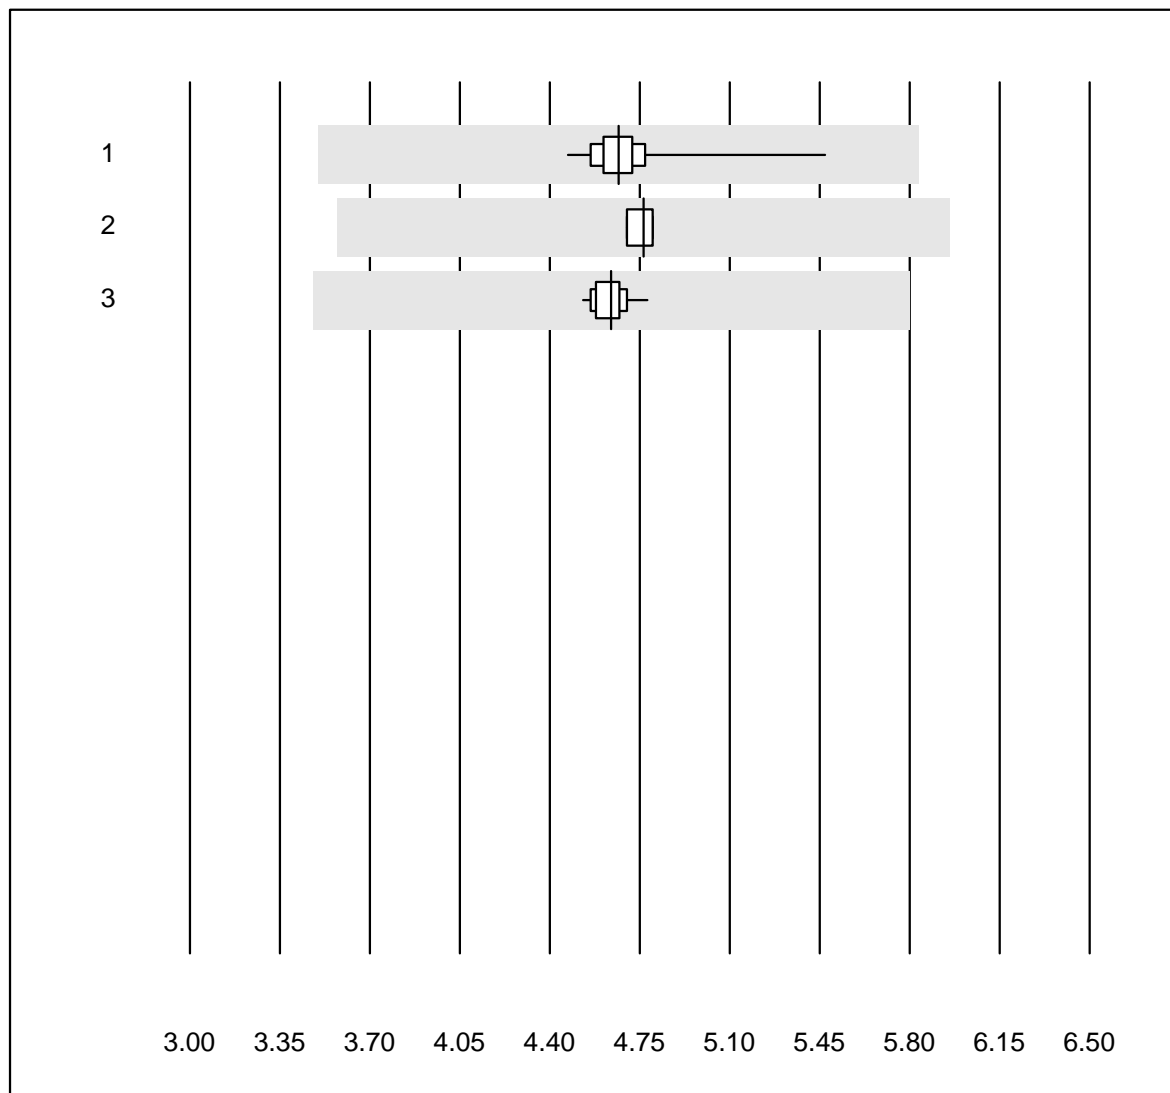


QUALAB Toleranz : 25 %

Erythrocytes (T/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex	74	100.0	0.0	0.0	4.67	2.6	e
2	Advia	4	100.0	0.0	0.0	4.77	1.1	e
3	Yumizen/Pentra	17	100.0	0.0	0.0	4.64	1.4	e

Leucocytes

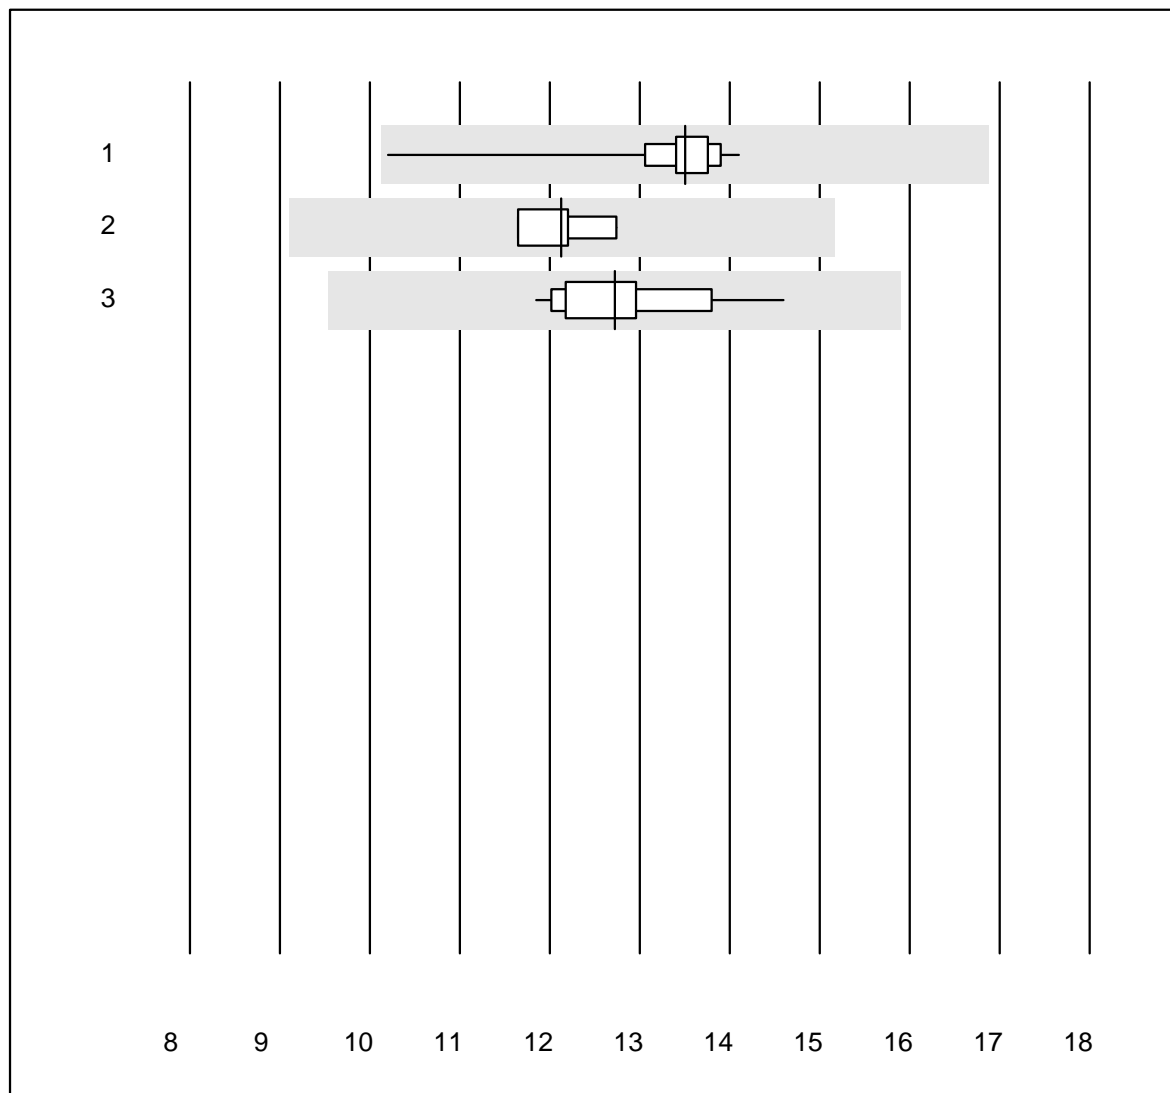


QUALAB Toleranz : 25 %

Leucocytes (G/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	73	100.0	0.0	0.0	13.50	3.9	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	12.13	3.7	e
3 Yumizen/Pentra	17	100.0	0.0	0.0	12.72	5.7	e

Thrombocytes

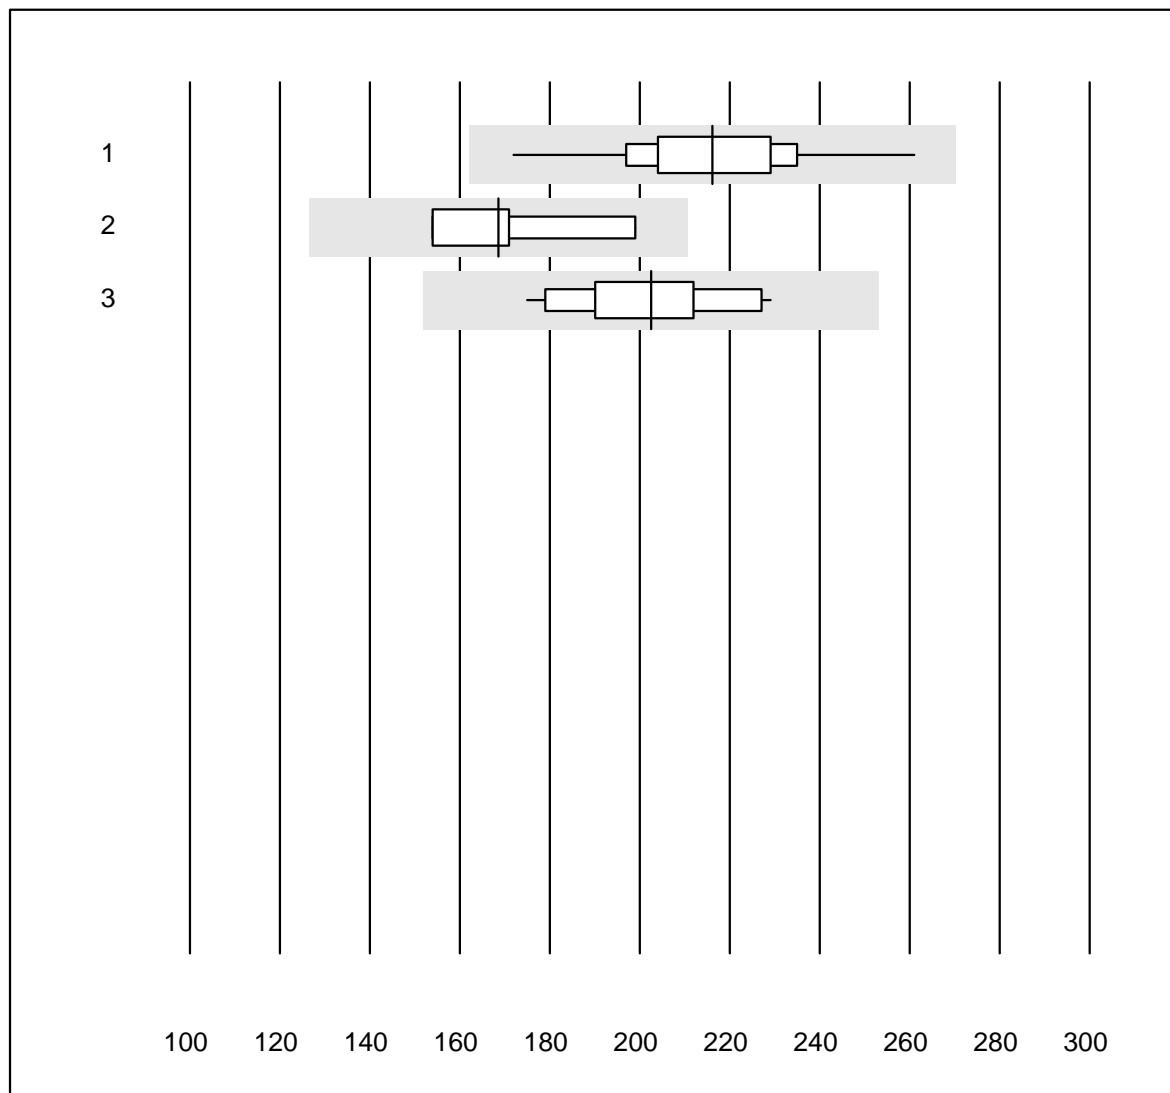


QUALAB Toleranz : 25 %

Thrombocytes (G/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	74	100.0	0.0	0.0	216.1	7.9	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	168.5	11.0	e*
3 Yumizen/Pentra	17	100.0	0.0	0.0	202.5	8.2	e

Neutrophiles

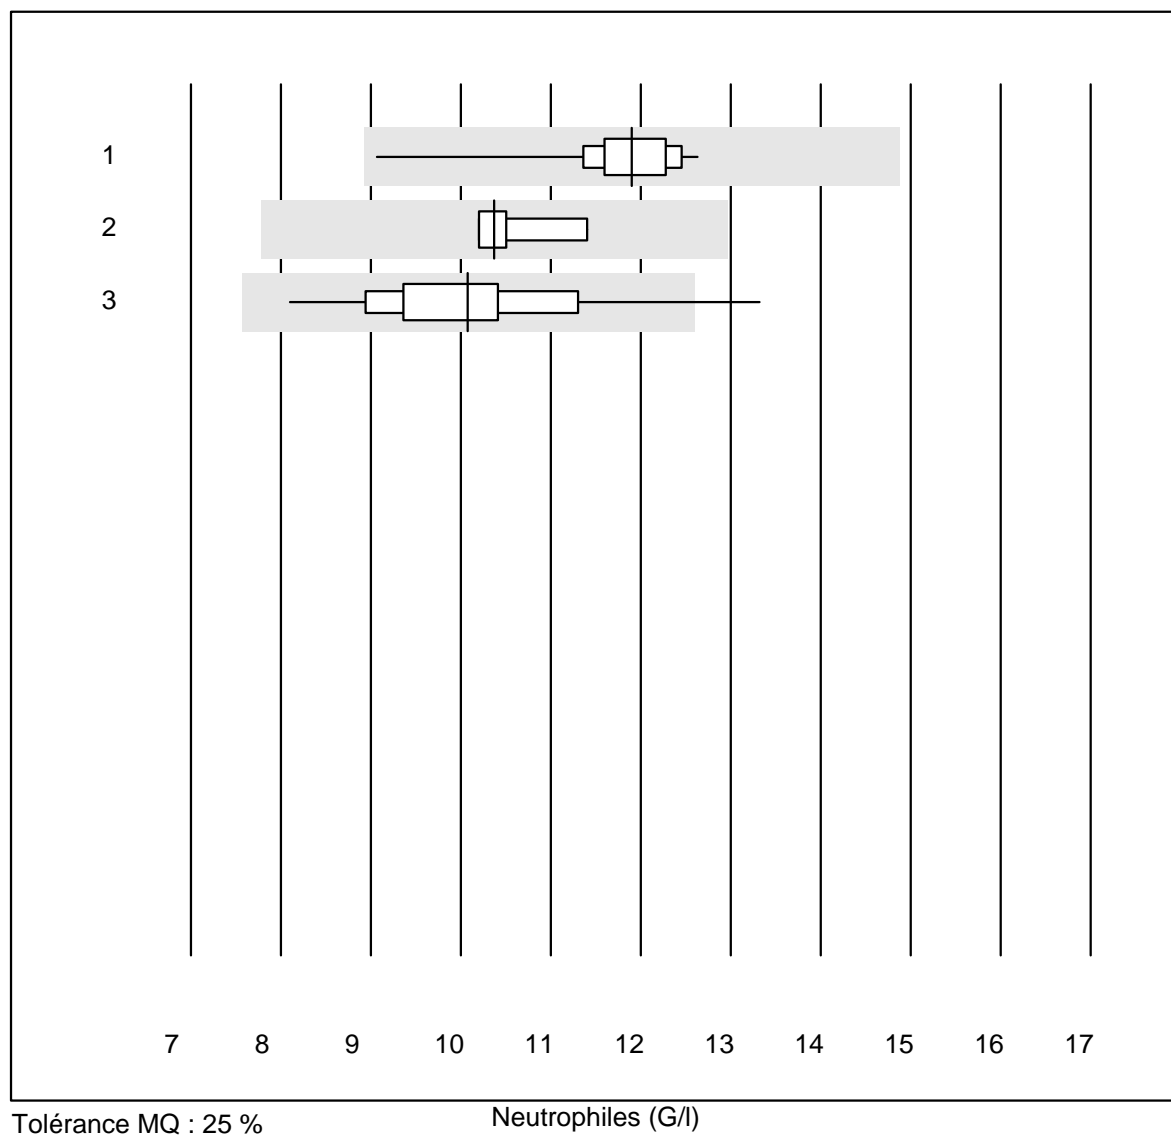


Tolérance MQ : 25 %

Neutrophiles (G/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	74	100.0	0.0	0.0	11.90	4.4	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	10.37	5.3	e
3 Yumizen/Pentra	16	93.7	6.3	0.0	10.08	11.5	e

Lymphocytes

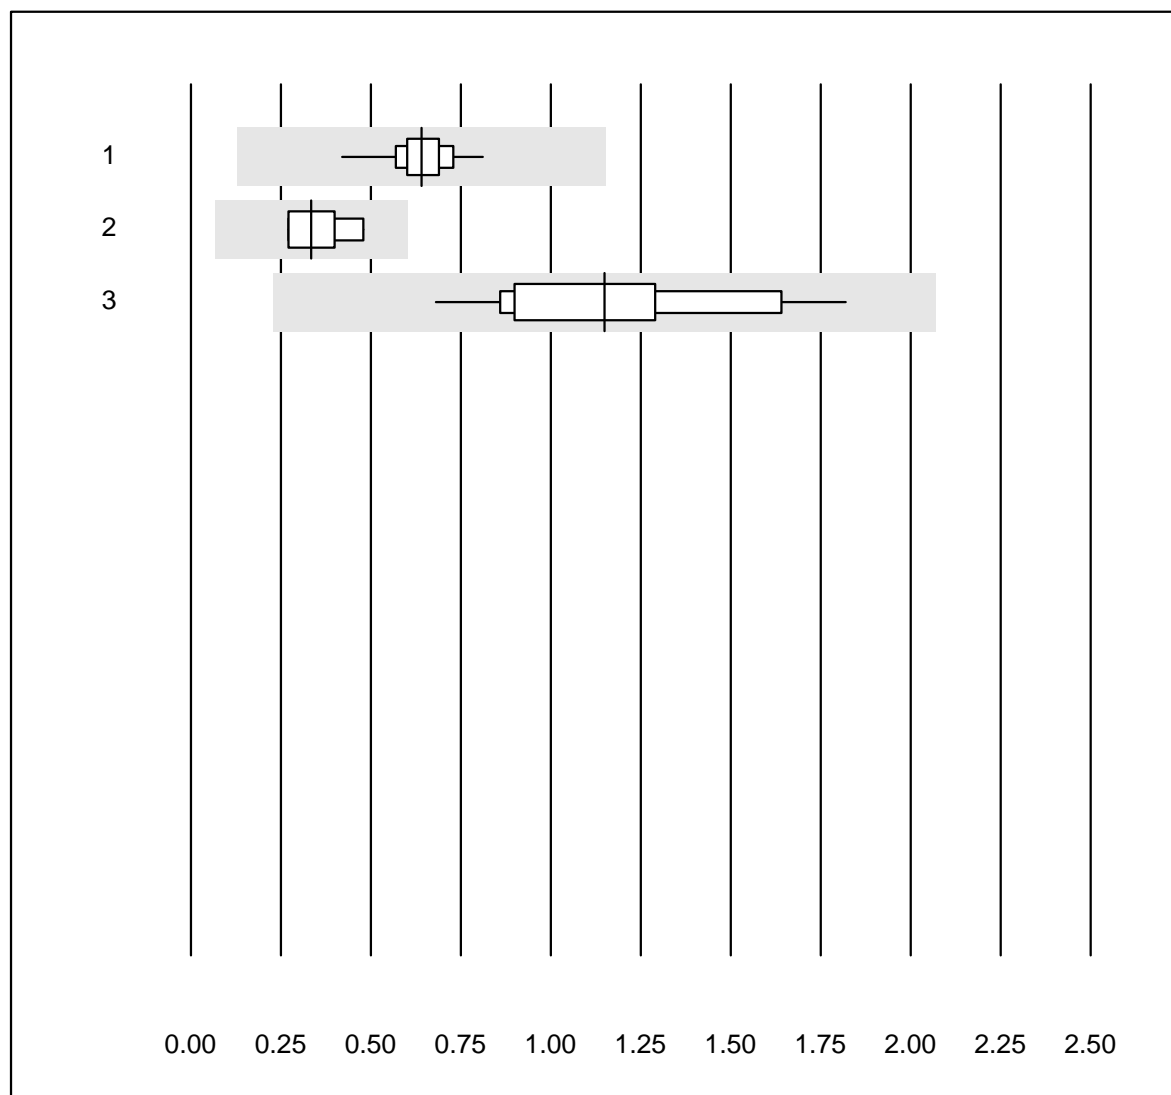


Tolérance MQ : 25 %

Lymphocytes (G/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex	74	100.0	0.0	0.0	0.64	10.4	a
2	Advia	4	100.0	0.0	0.0	0.34	29.1	a
3	Yumizen/Pentra	17	100.0	0.0	0.0	1.15	27.2	a

Monocytes

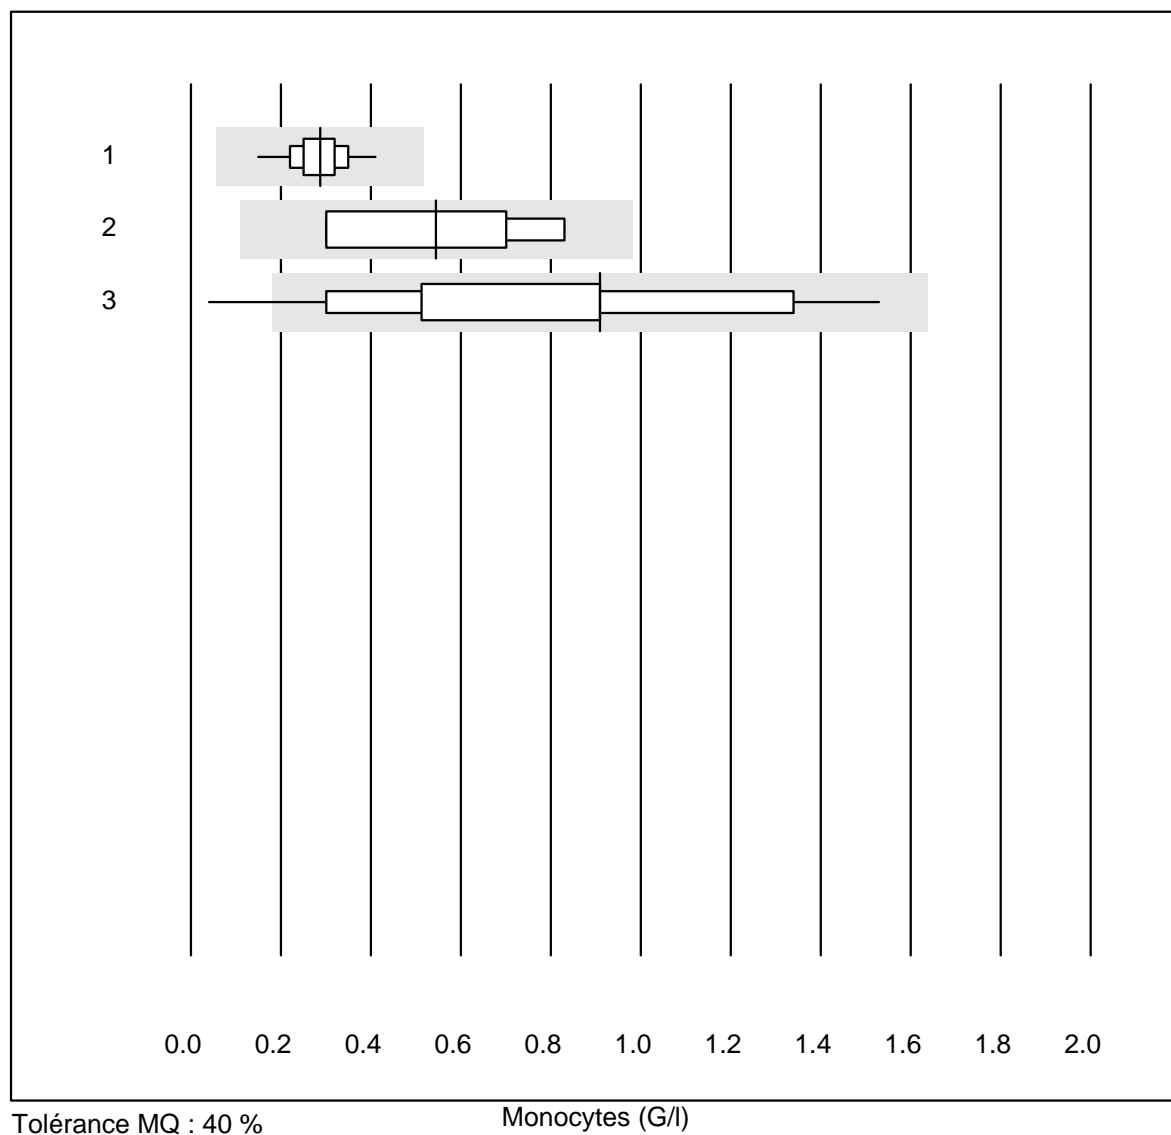

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex	74	100.0	0.0	0.0	0.29	19.1	a
2	Advia	4	100.0	0.0	0.0	0.55	45.2	a
3	Yumizen/Pentra	16	87.4	6.3	6.3	0.91	52.5	a

Eosinophiles

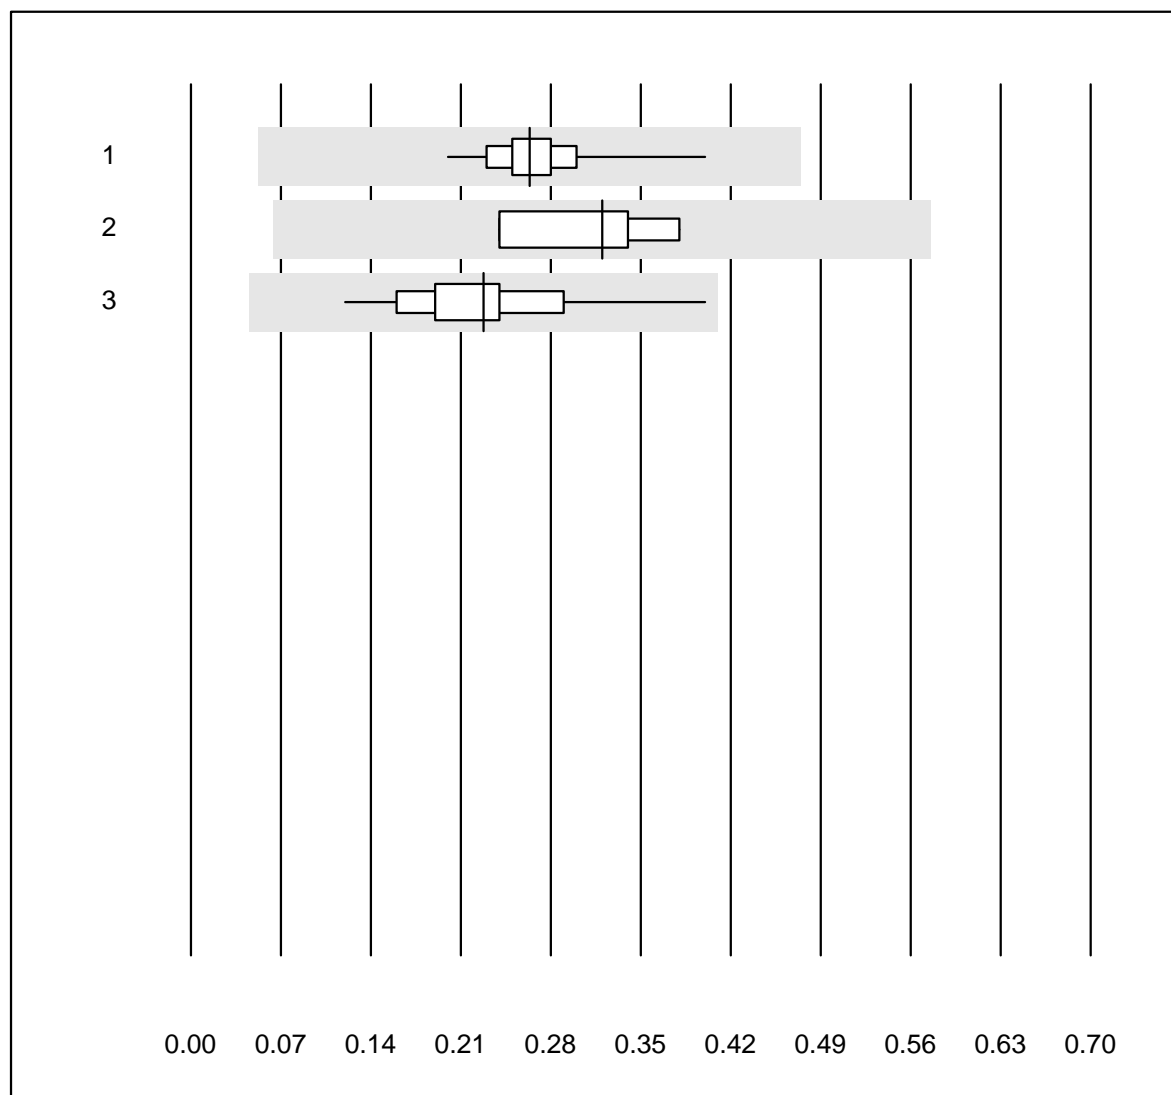


Tolérance MQ : 80 %

Eosinophiles (G/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	74	100.0	0.0	0.0	0.26	11.9	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	0.32	19.0	e
3 Yumizen/Pentra	17	100.0	0.0	0.0	0.23	26.6	e

Basophiles

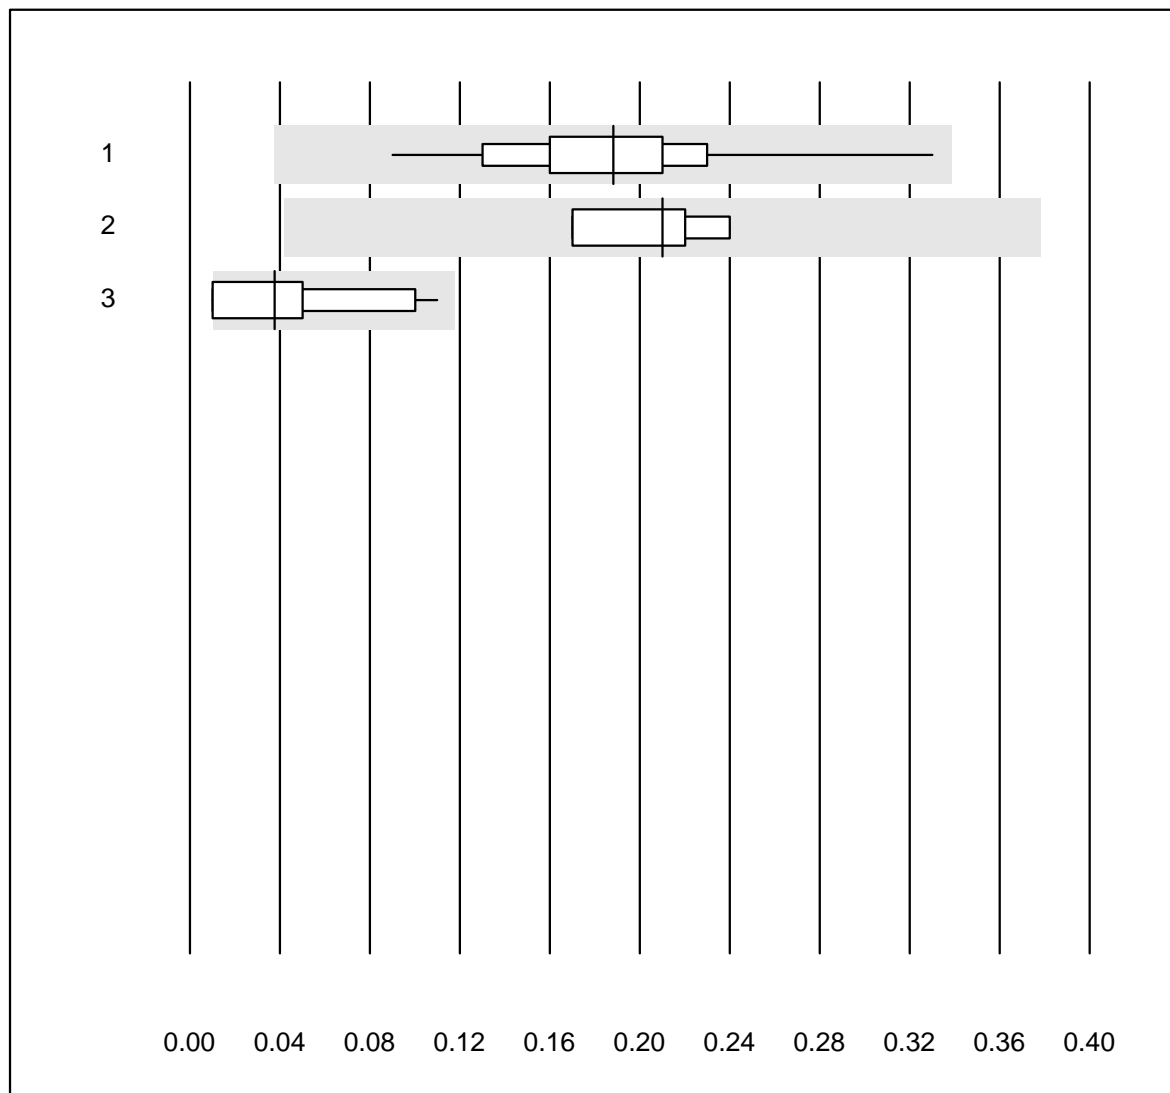


Tolérance MQ : 80 %
 (< 0.10: +/- 0.08 G/l)

Basophiles (G/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	74	100.0	0.0	0.0	0.19	25.3	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	0.21	14.4	e
3 Yumizen/Pentra	17	94.1	0.0	5.9	0.04	95.2	e*

MCV

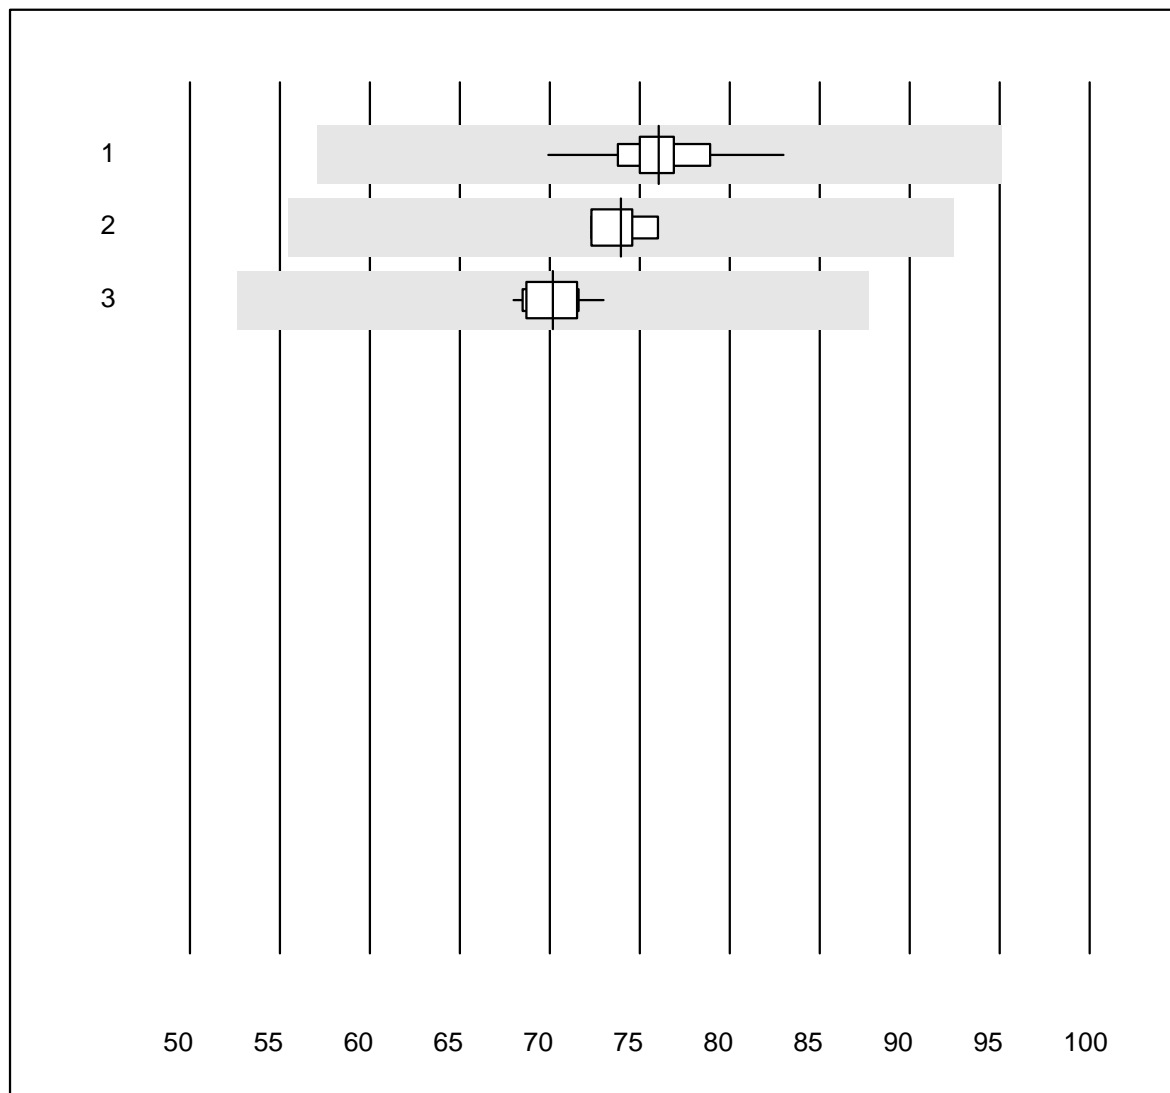


Tolérance MQ : 25 %

MCV (fl)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	66	100.0	0.0	0.0	76.1	2.9	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	74.0	2.2	e
3 Yumizen/Pentra	11	100.0	0.0	0.0	70.2	2.2	e

MCH

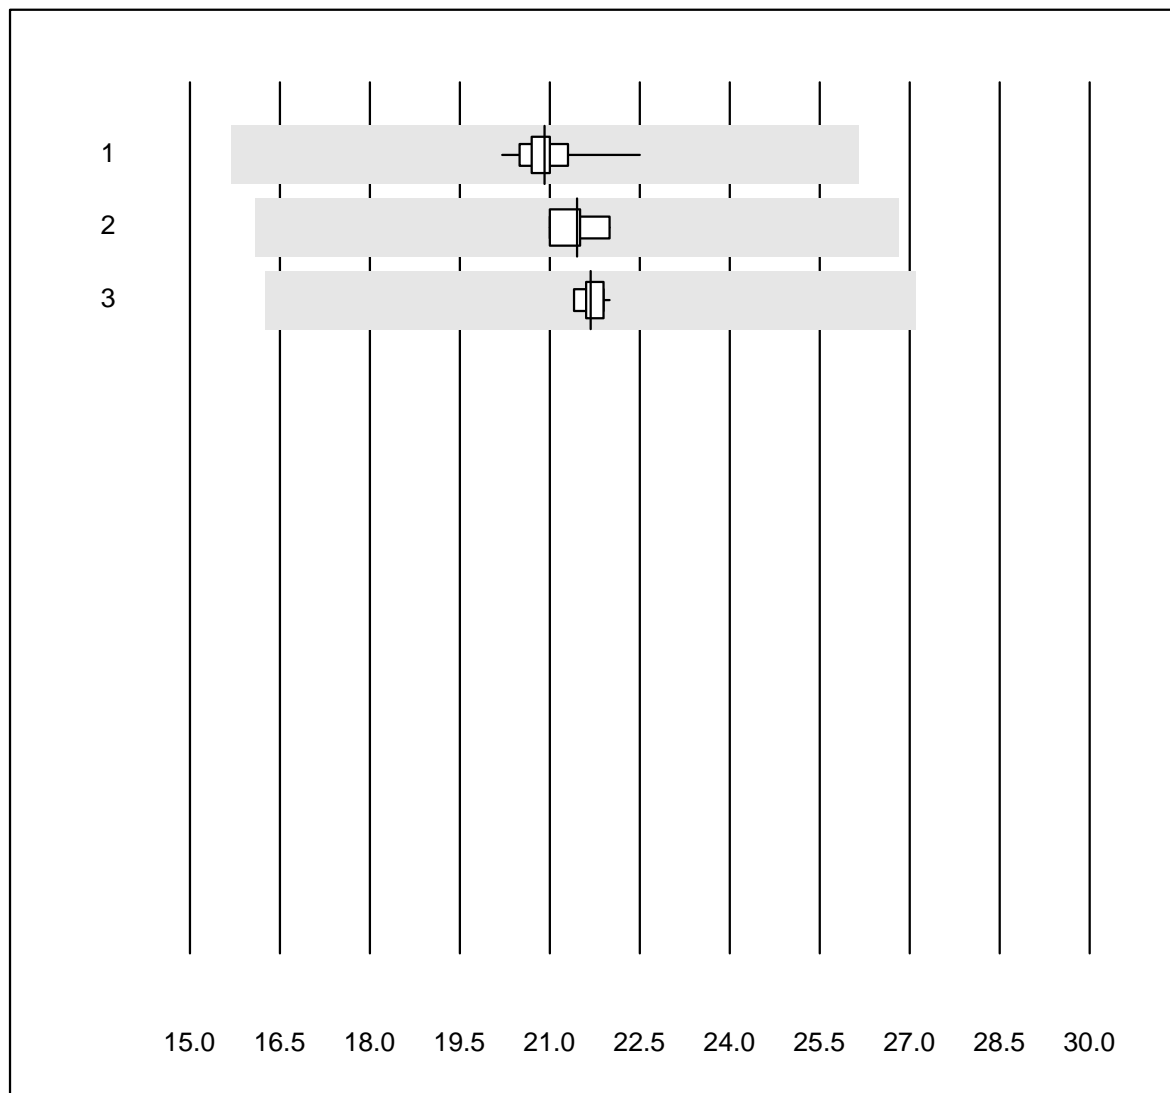


Tolérance MQ : 25 %

MCH (pg)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	65	100.0	0.0	0.0	20.9	1.7	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	21.5	1.9	e
3 Yumizen/Pentra	11	100.0	0.0	0.0	21.7	0.9	e

MCHC

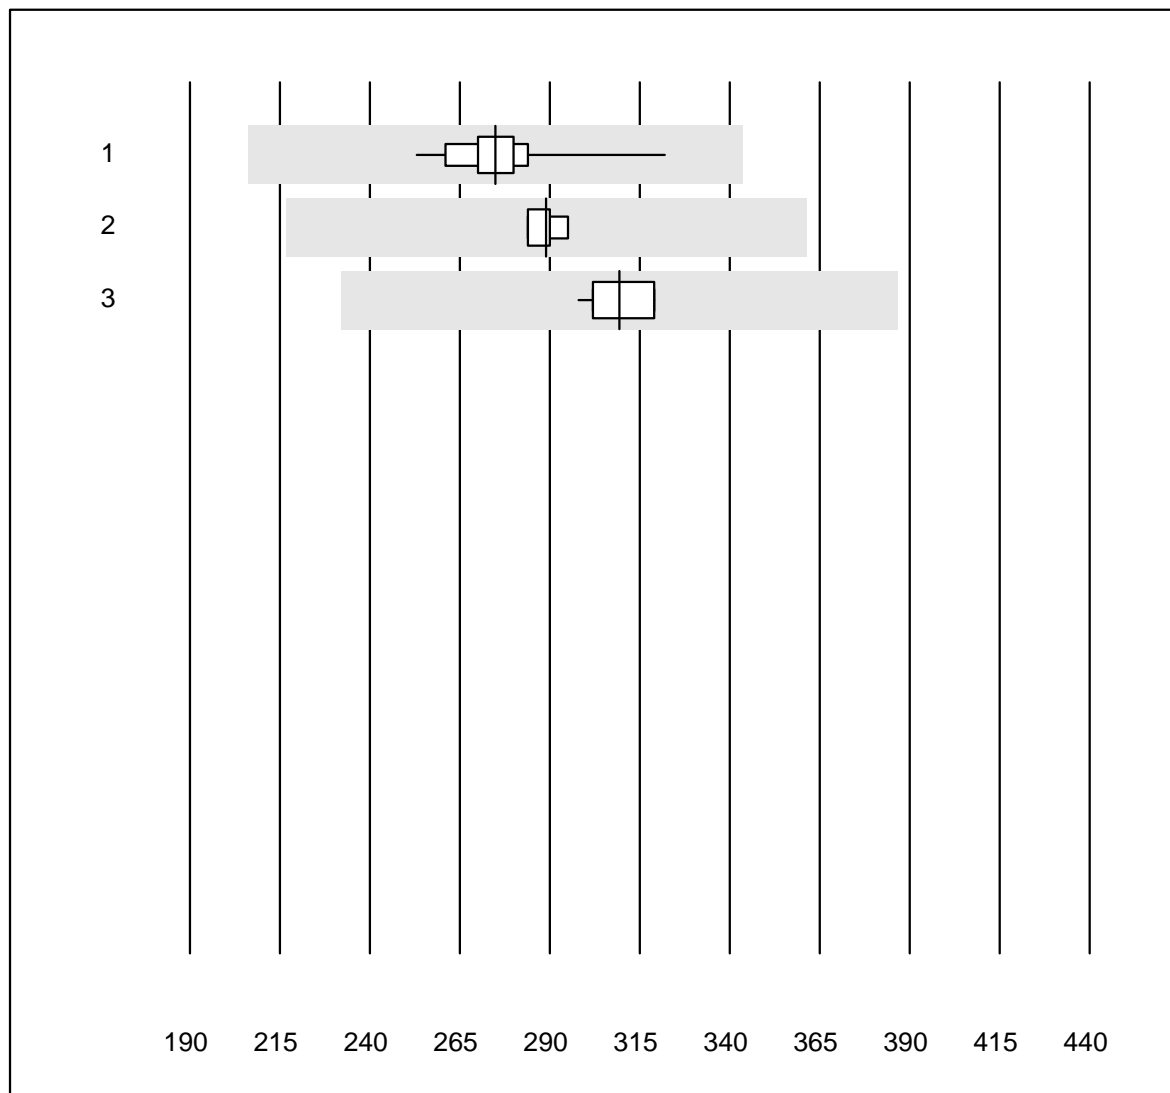


Tolérance MQ : 25 %

MCHC (g/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	66	100.0	0.0	0.0	275	3.6	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	289	1.6	e
3 Yumizen/Pentra	11	100.0	0.0	0.0	309	2.4	e

RDW

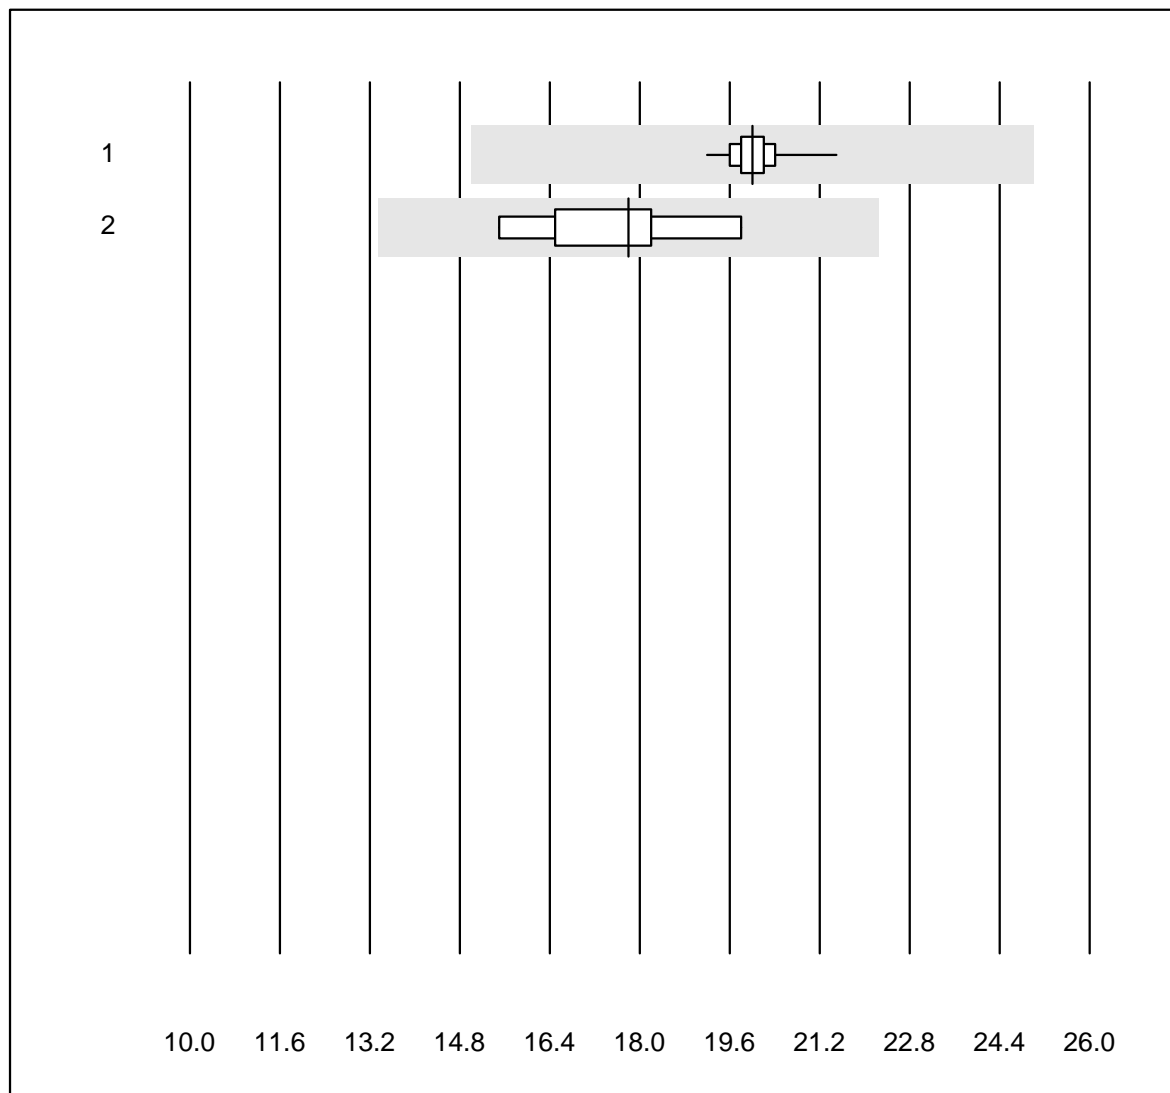


Tolérance MQ : 25 %

RDW (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Sysmex	63	100.0	0.0	0.0	20.0	1.9	e
2	Yumizen/Pentra	9	100.0	0.0	0.0	17.8	8.3	e

Immature Granulocytes

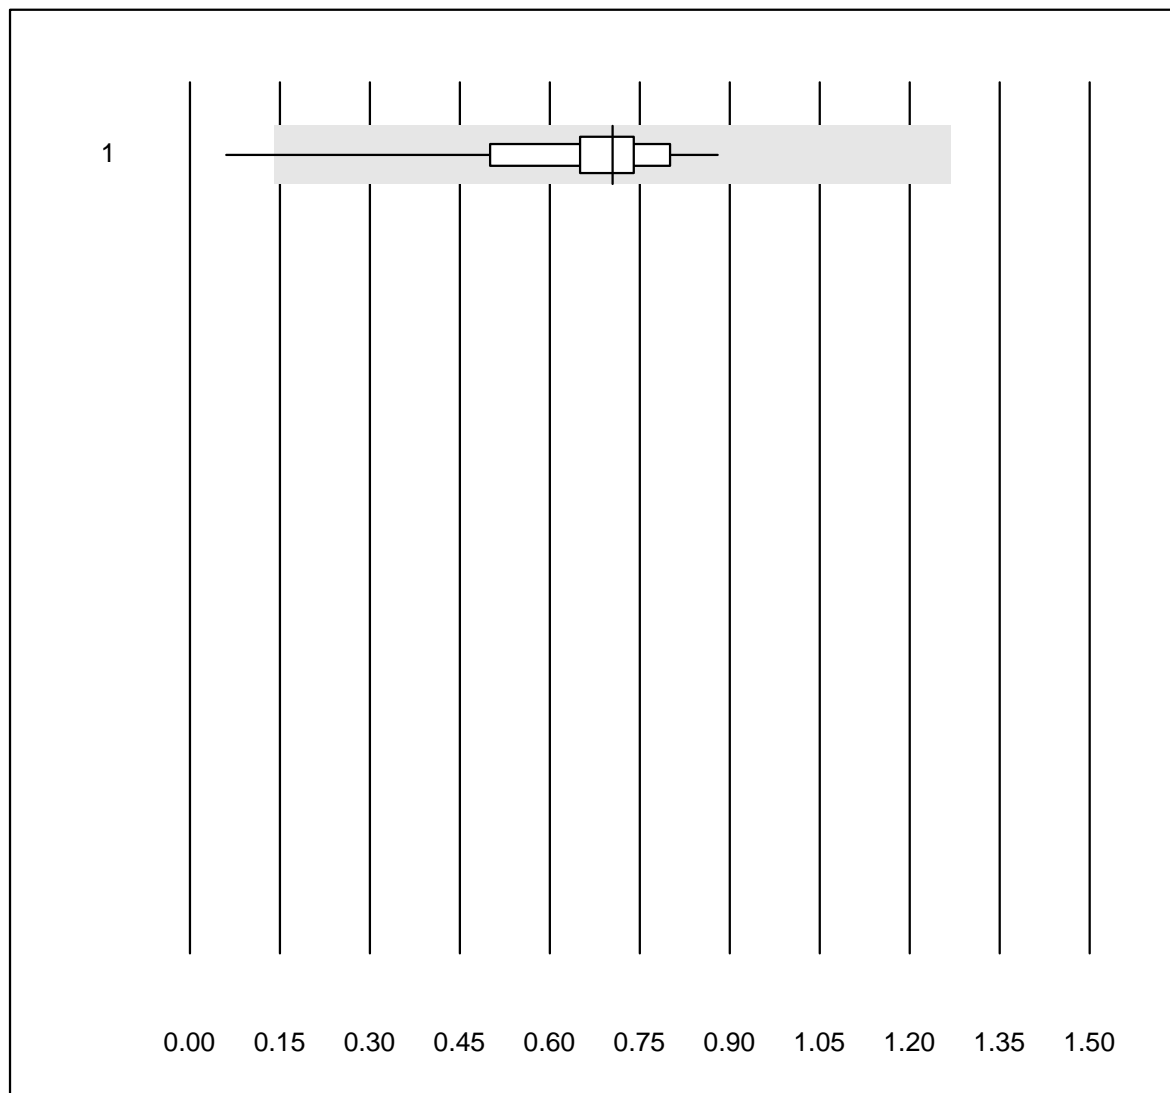


Tolérance MQ : 25 %

Immature Granulocytes (G/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	54	98.1	1.9	0.0	0.70	24.1	a

Réticulocytes

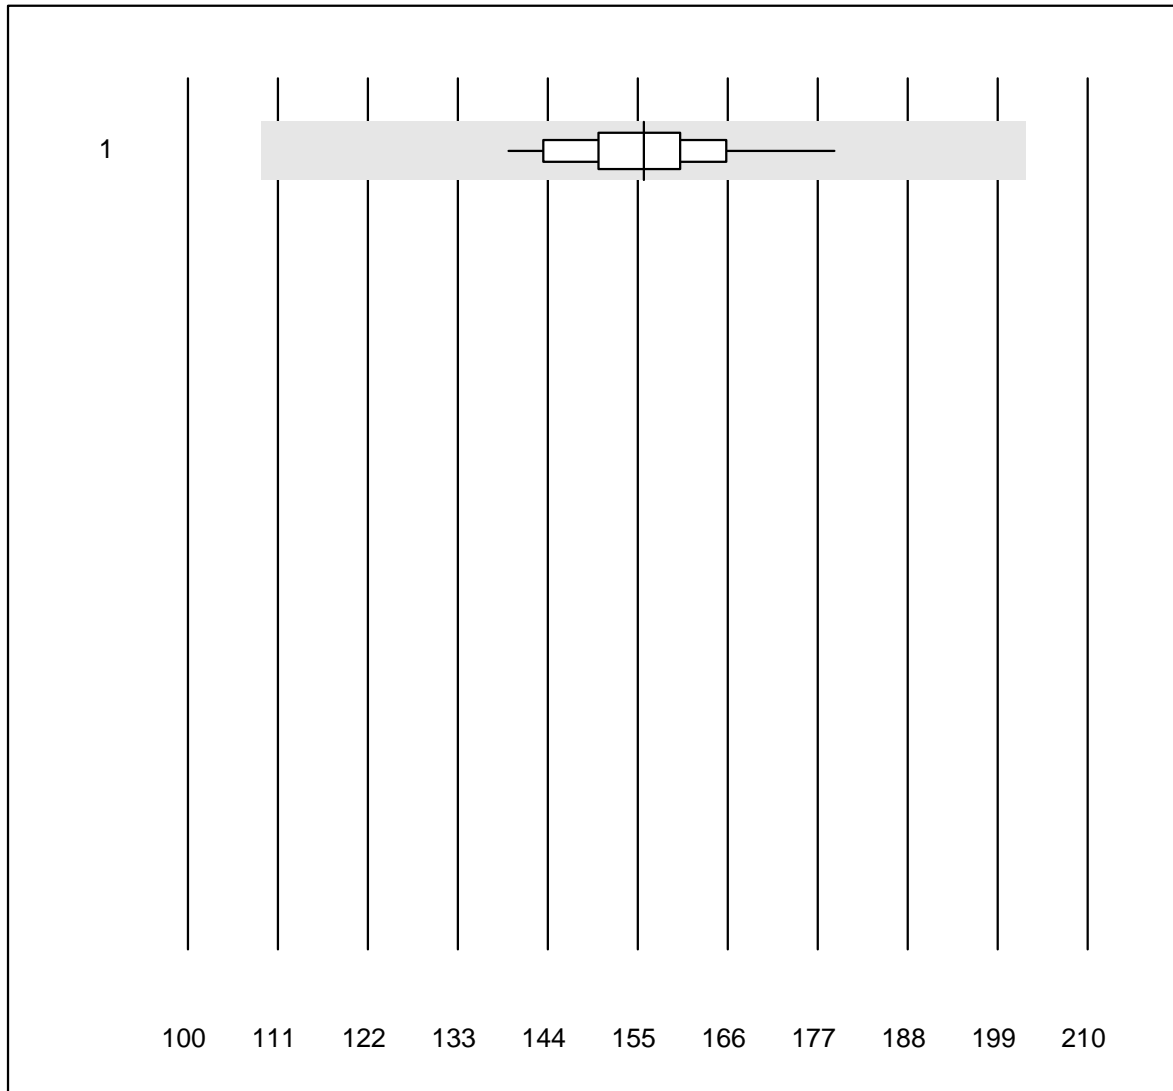


Tolérance MQ : 30 %

Réticulocytes (G/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Sysmex	38	100.0	0.0	0.0	155.7	5.6	e

Index hémolytique échantillon A

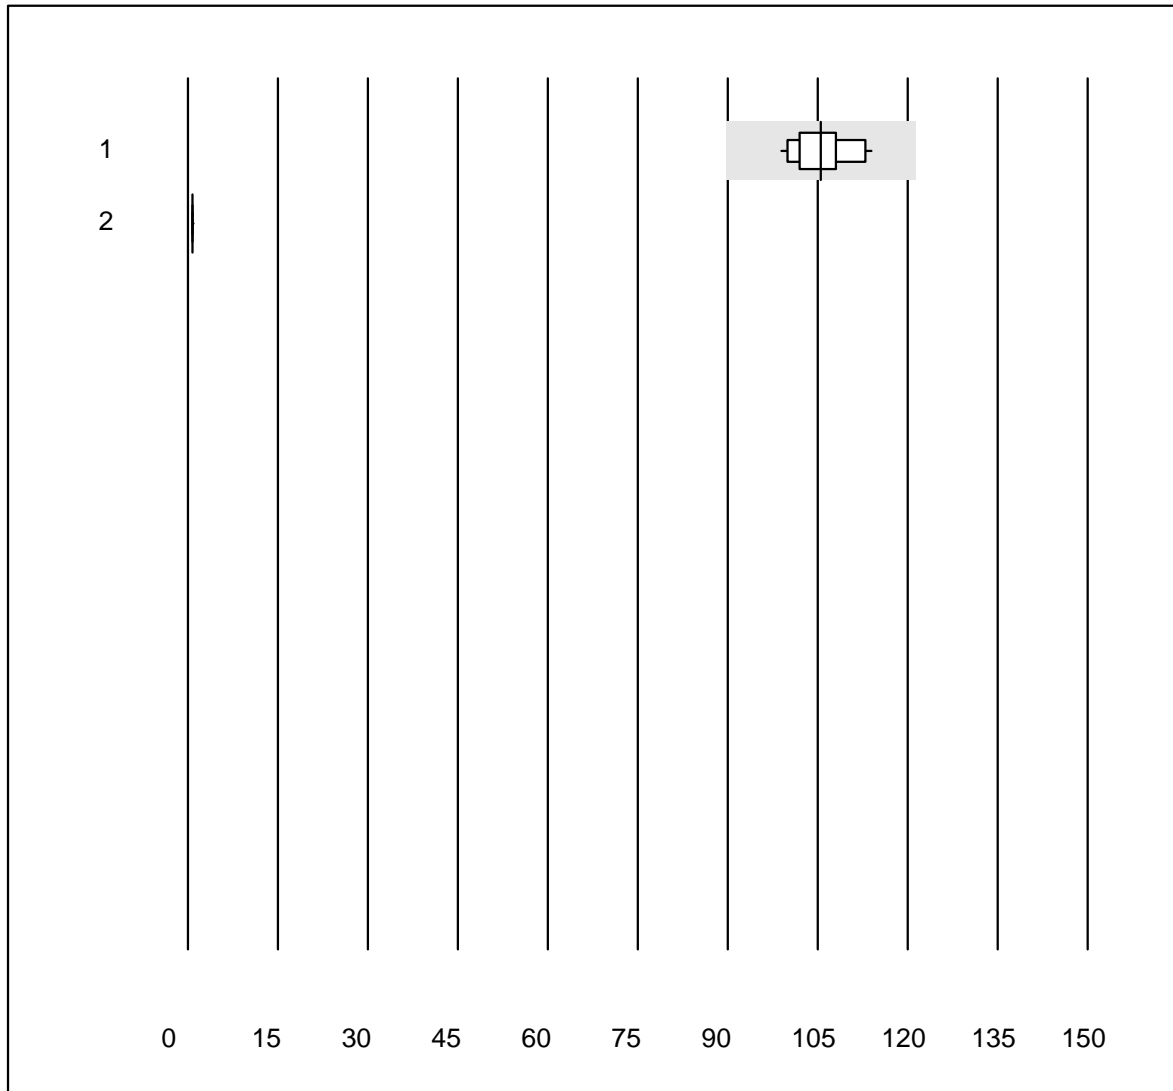


Tolérance MQ : 15 %

Index hémolytique échantillon A ()

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	16	100.0	0.0	0.0	105.56	4.0	e
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	0.74	2.5	e

Index hémolytique échantillon B

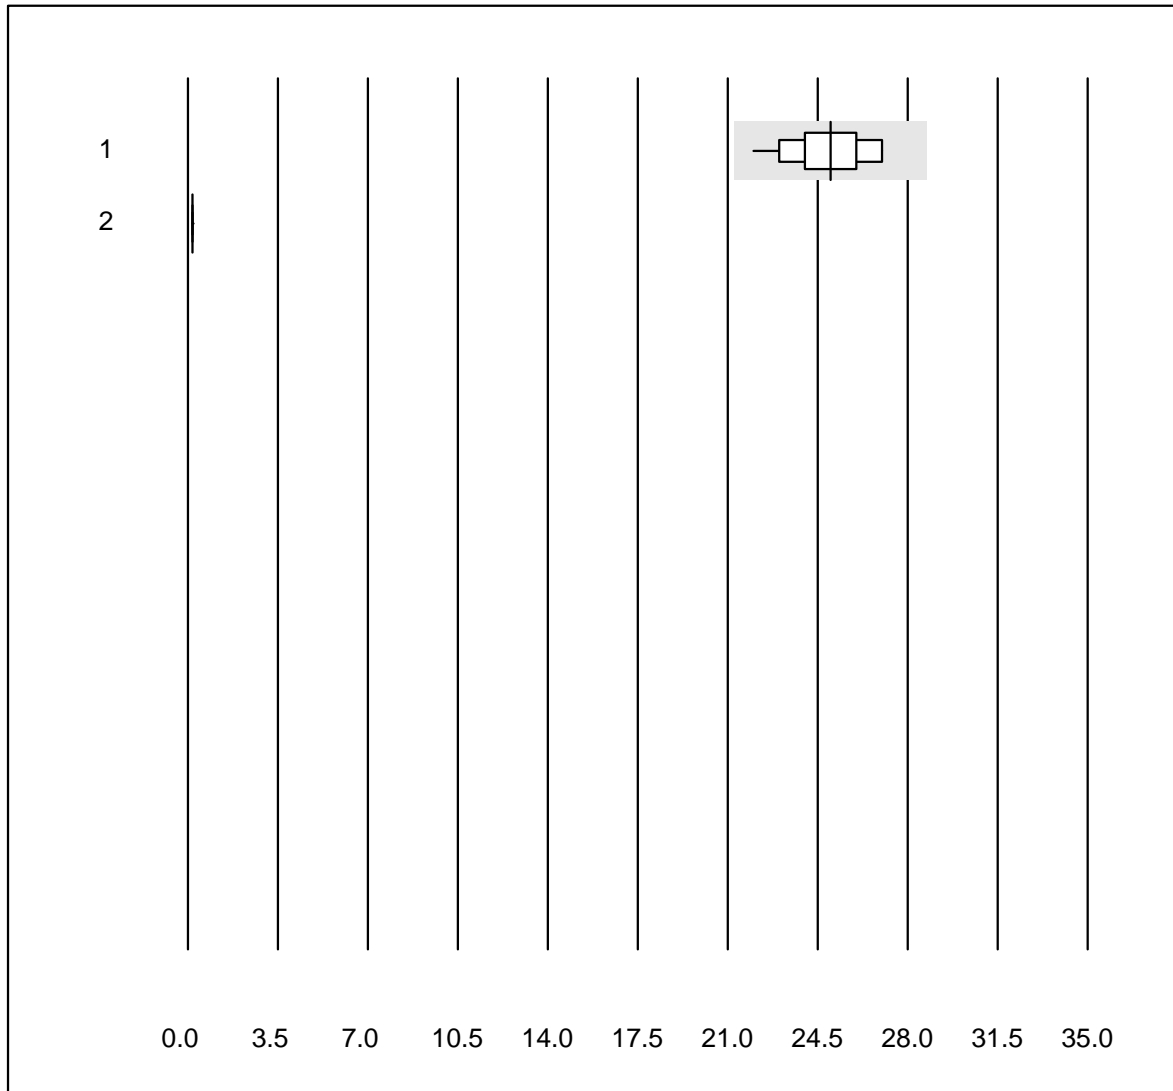


Tolérance MQ : 15 %

Index hémolytique échantillon B ()

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	25.00	5.5	e
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	0.17	2.9	e

Vitesse de sédimentation 1h

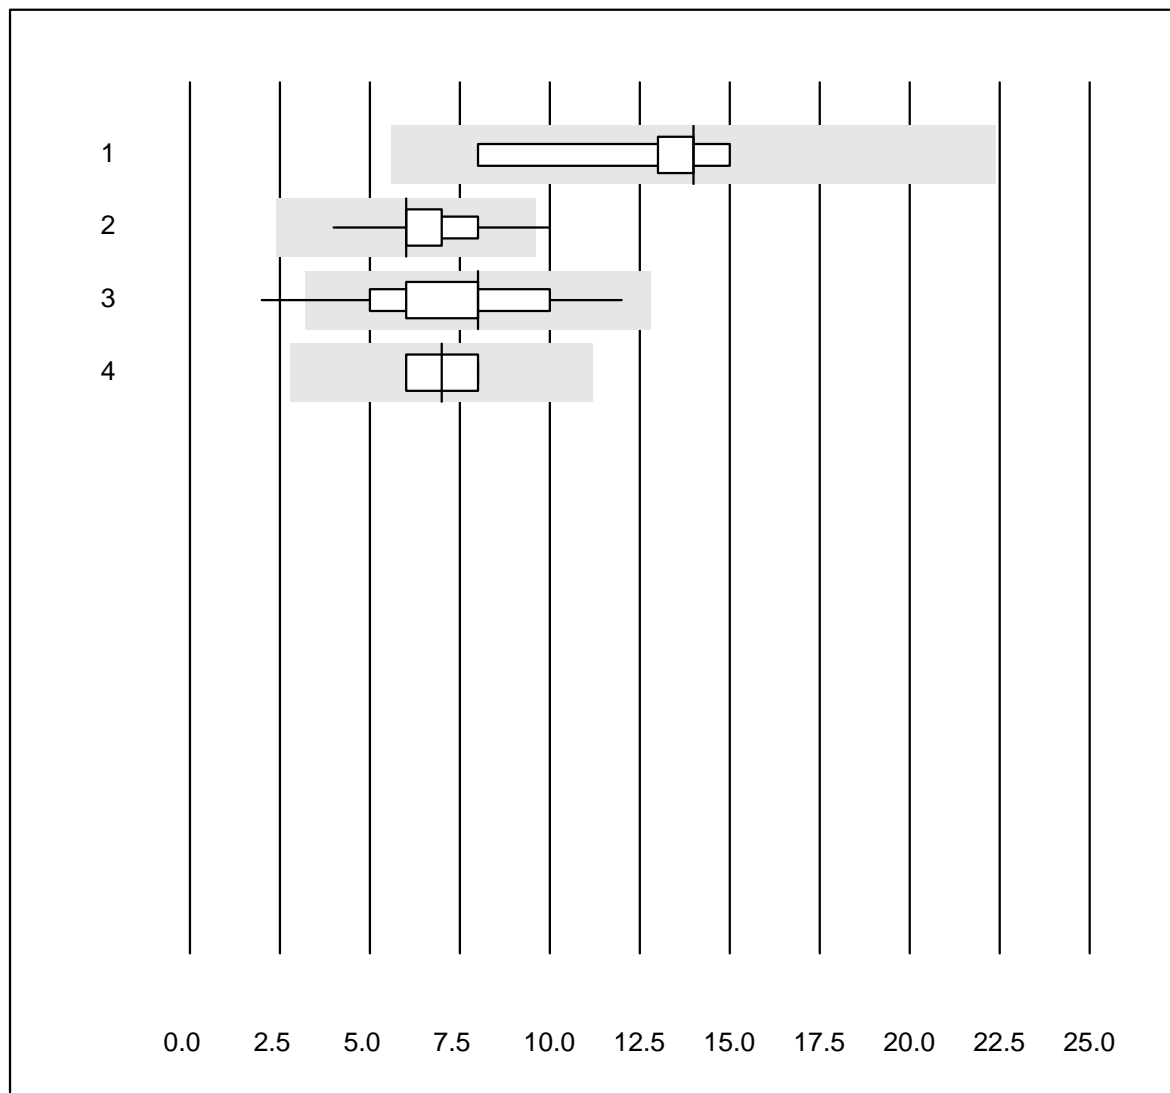


Tolérance MQ : 30 %

Vitesse de sédimentation 1h (mm/h)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	MINI-CUBE	7	71.4	0.0	28.6	14	21.7	a
2	Sarstedt Sedivette	12	91.7	8.3	0.0	6	22.5	a
3	BD Seditainer	35	97.1	2.9	0.0	8	30.7	a
4	Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	7	16.5	a

Vitesse de sédimentation 2h

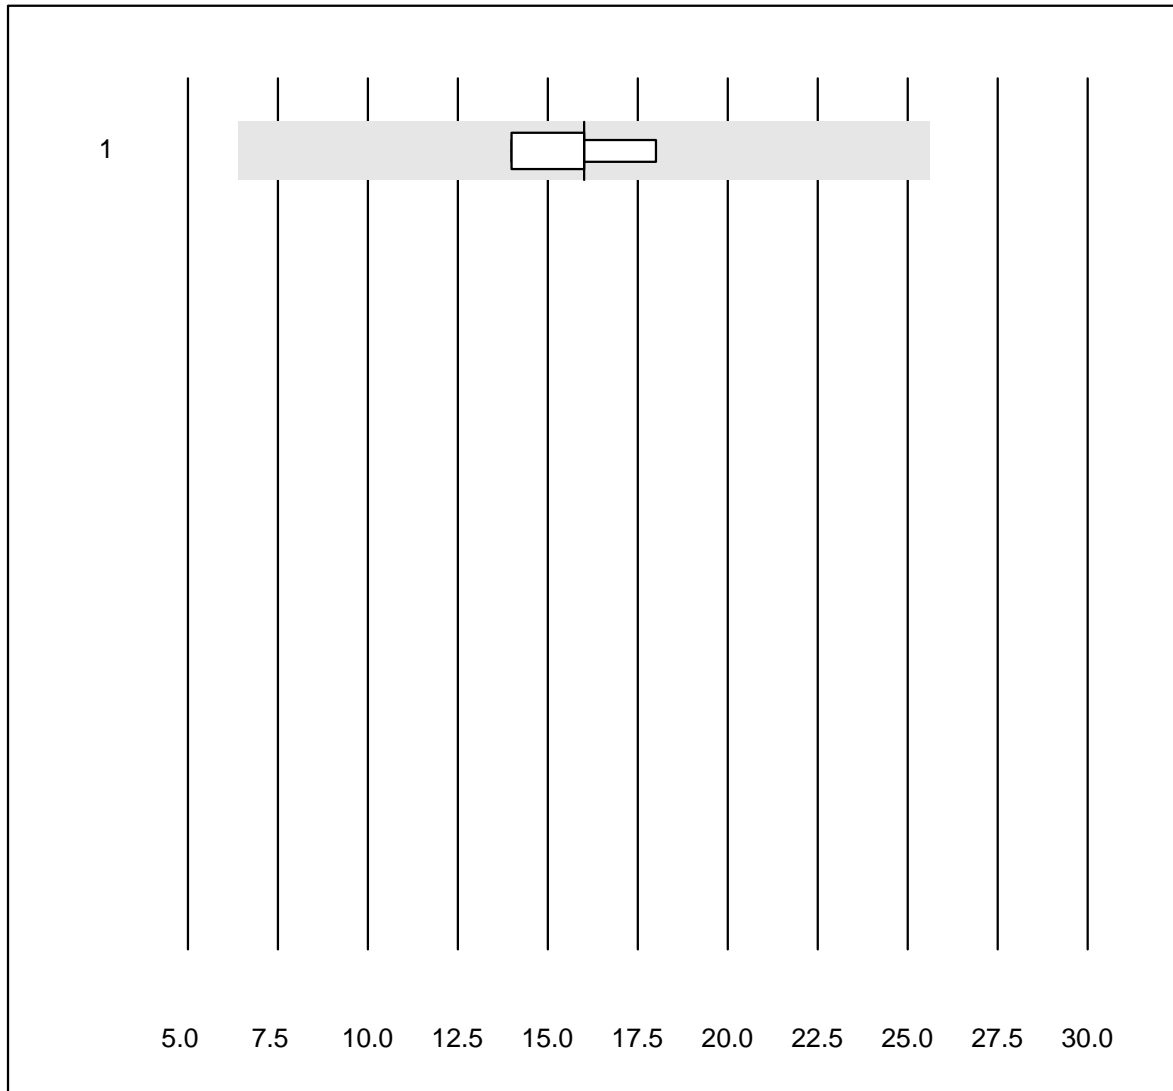


Tolérance MQ : 30 %

Vitesse de sédimentation 2h (mm/2h)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	BD Seditainer	6	100.0	0.0	0.0	16	11.2	a

CRP

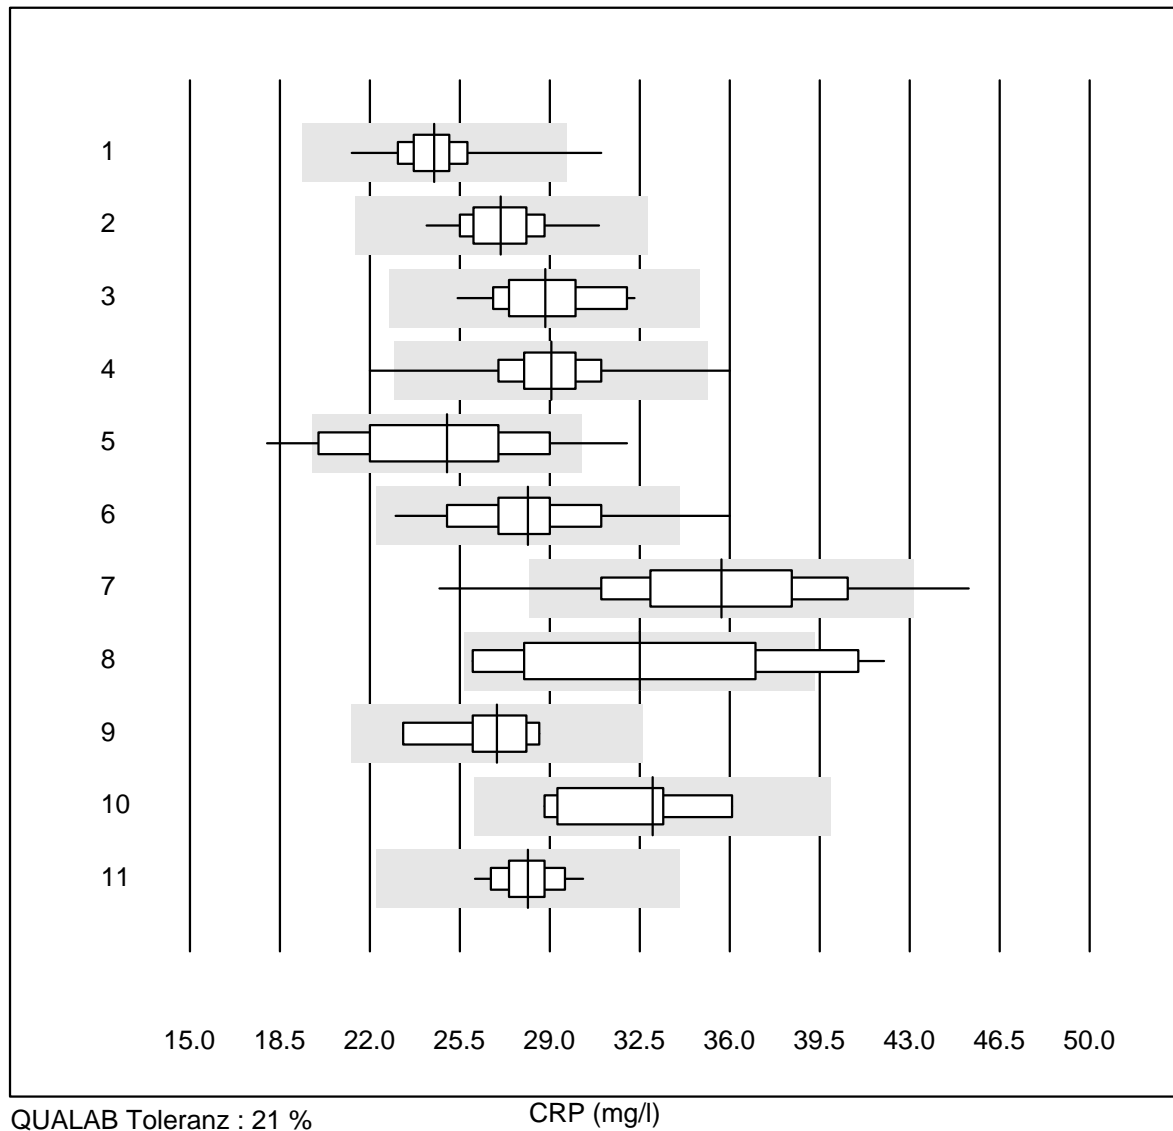


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas b101	290	99.3	0.7	0.0	24.5	5.2	e
2	Cobas	22	100.0	0.0	0.0	27.1	5.6	e
3	Turbidimetrie	15	100.0	0.0	0.0	28.8	6.5	e
4	Afinion	1262	99.3	0.3	0.4	29.1	6.3	e
5	NycoCard SingleTest-	110	74.5	8.2	17.3	25.0	13.2	e
6	Quick Read go	102	97.0	2.0	1.0	28.2	7.7	e
7	Eurolyser	92	75.0	5.4	19.6	35.7	11.6	e
8	Fuji Dri-Chem	13	76.9	15.4	7.7	32.5	17.2	e*
9	Autolyser/DiaSys	10	90.0	0.0	10.0	27.0	6.9	e
10	Piccolo	5	100.0	0.0	0.0	33.0	9.5	e*
11	Celltac chemi	48	100.0	0.0	0.0	28.1	3.8	e

CRP

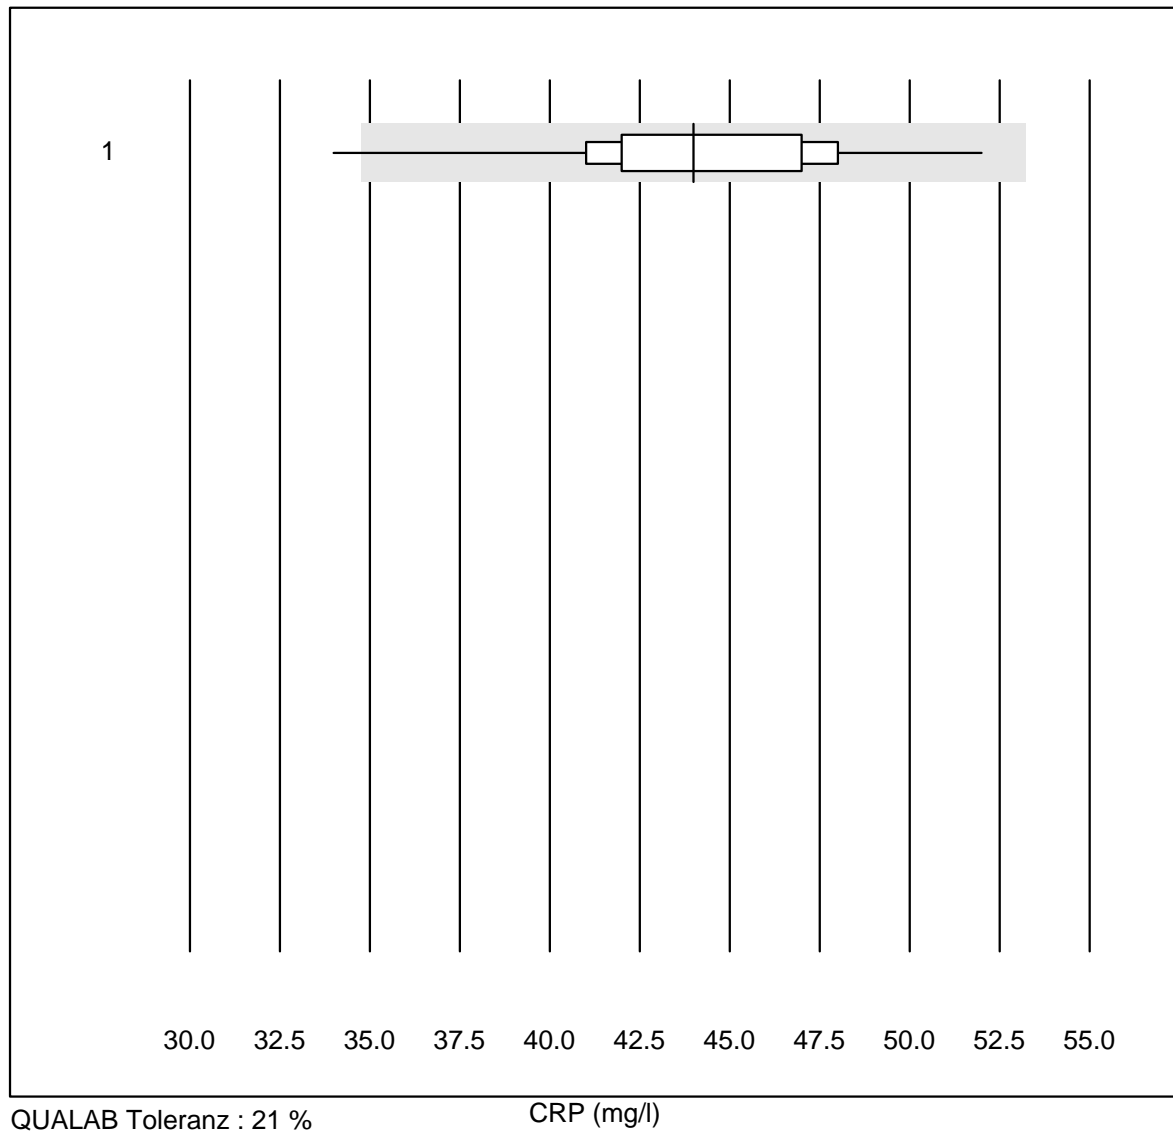


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	QuickRead (sang comp	34	88.3	2.9	8.8	44.0	8.8	e

CRP

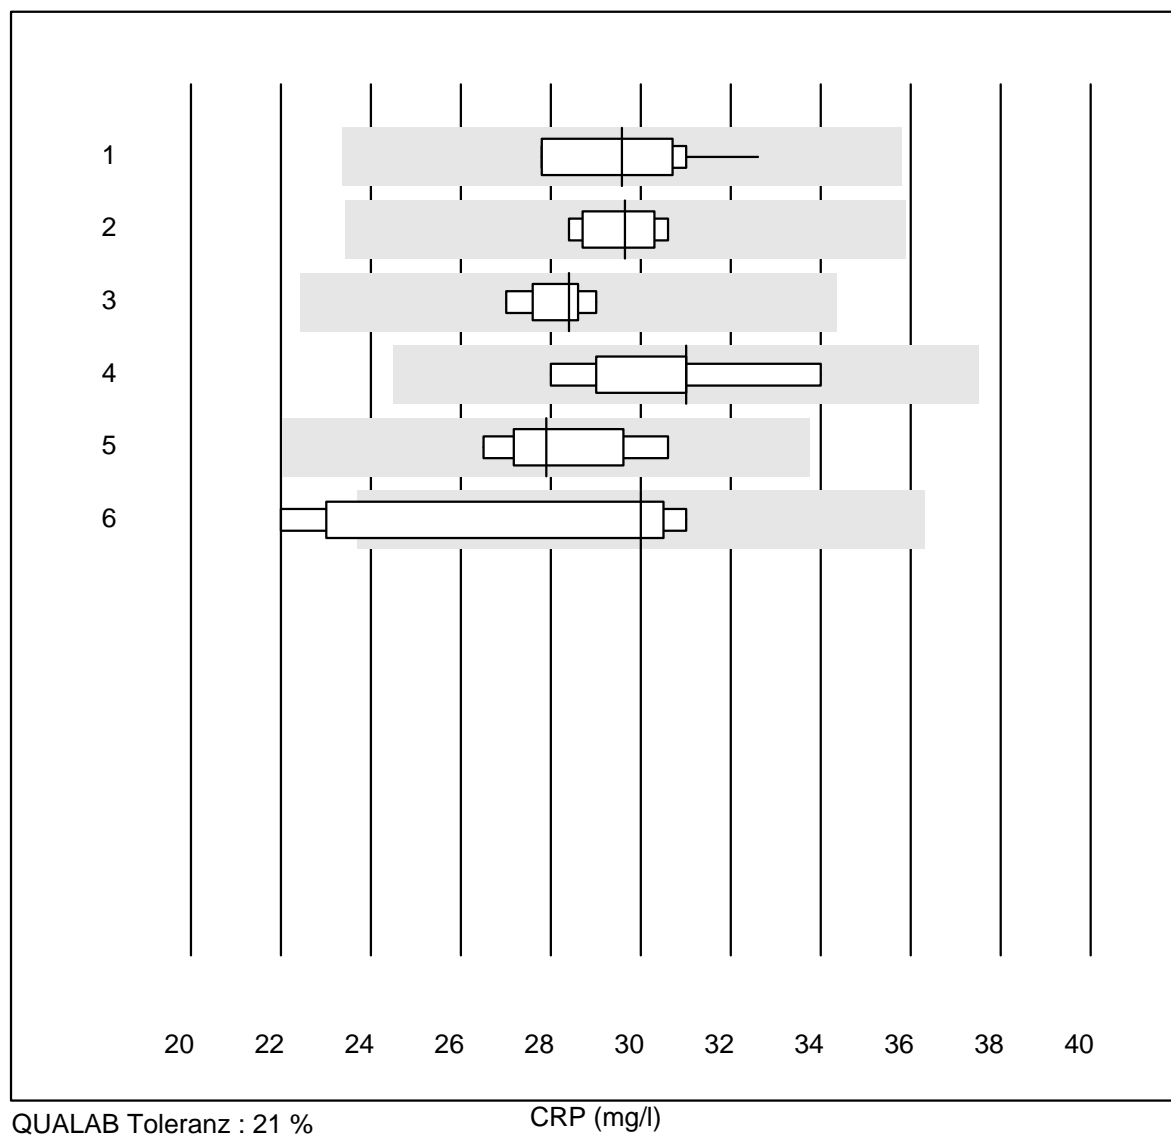

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Spinit	11	100.0	0.0	0.0	29.6	5.3	e
2 Architect	6	100.0	0.0	0.0	29.7	3.2	e
3 Beckman	5	100.0	0.0	0.0	28.4	2.9	e
4 AQT 90 FLEX	7	100.0	0.0	0.0	31.0	6.2	e
5 Spotchem D-Concept	5	100.0	0.0	0.0	27.9	6.0	e*
6 Autres méthodes	7	71.4	28.6	0.0	30.0	13.6	e*

IgG

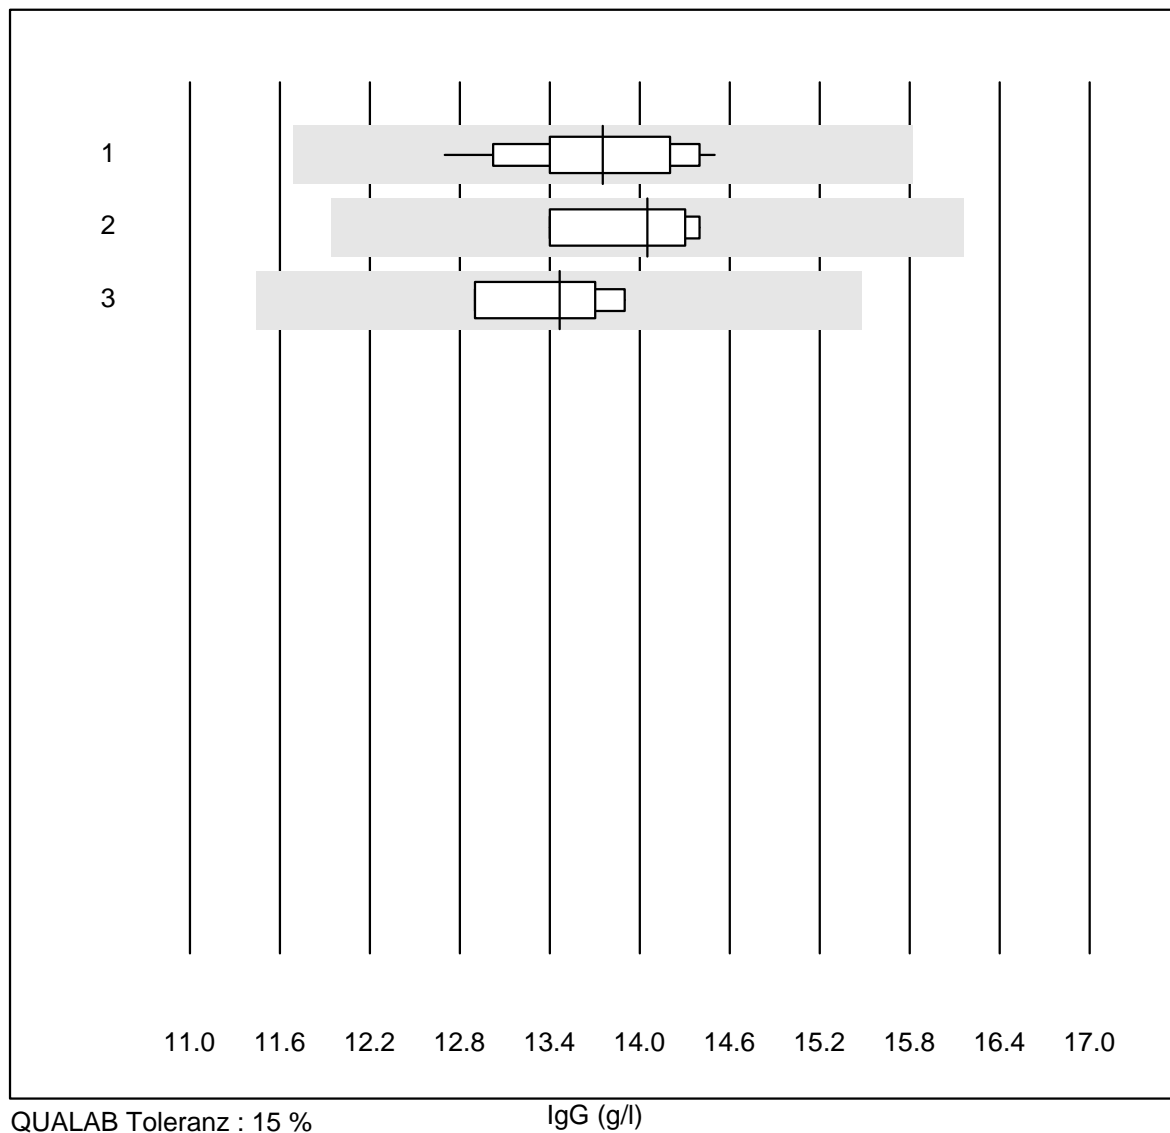


QUALAB Toleranz : 15 %

IgG (g/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Turbidimetrie	17	100.0	0.0	0.0	13.76	3.9	e
2 Nephelometrie	4	100.0	0.0	0.0	14.05	3.3	e
3 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	13.47	3.4	e

IgA

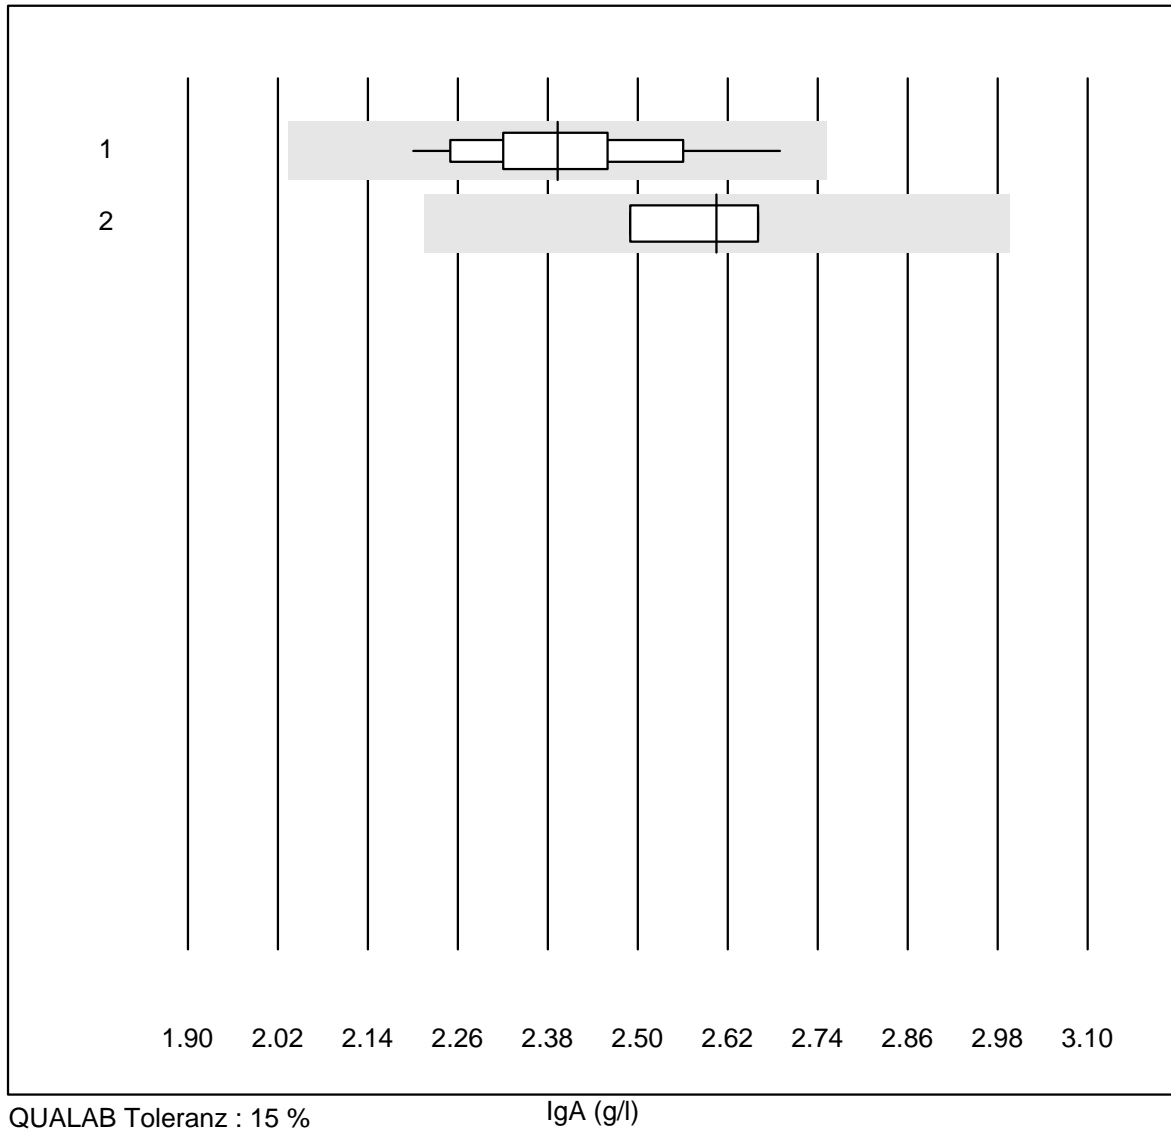


QUALAB Toleranz : 15 %

IgA (g/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Turbidimetrie	17	100.0	0.0	0.0	2.39	4.8	e
2	Nephelometrie	4	100.0	0.0	0.0	2.61	3.3	e

IgM

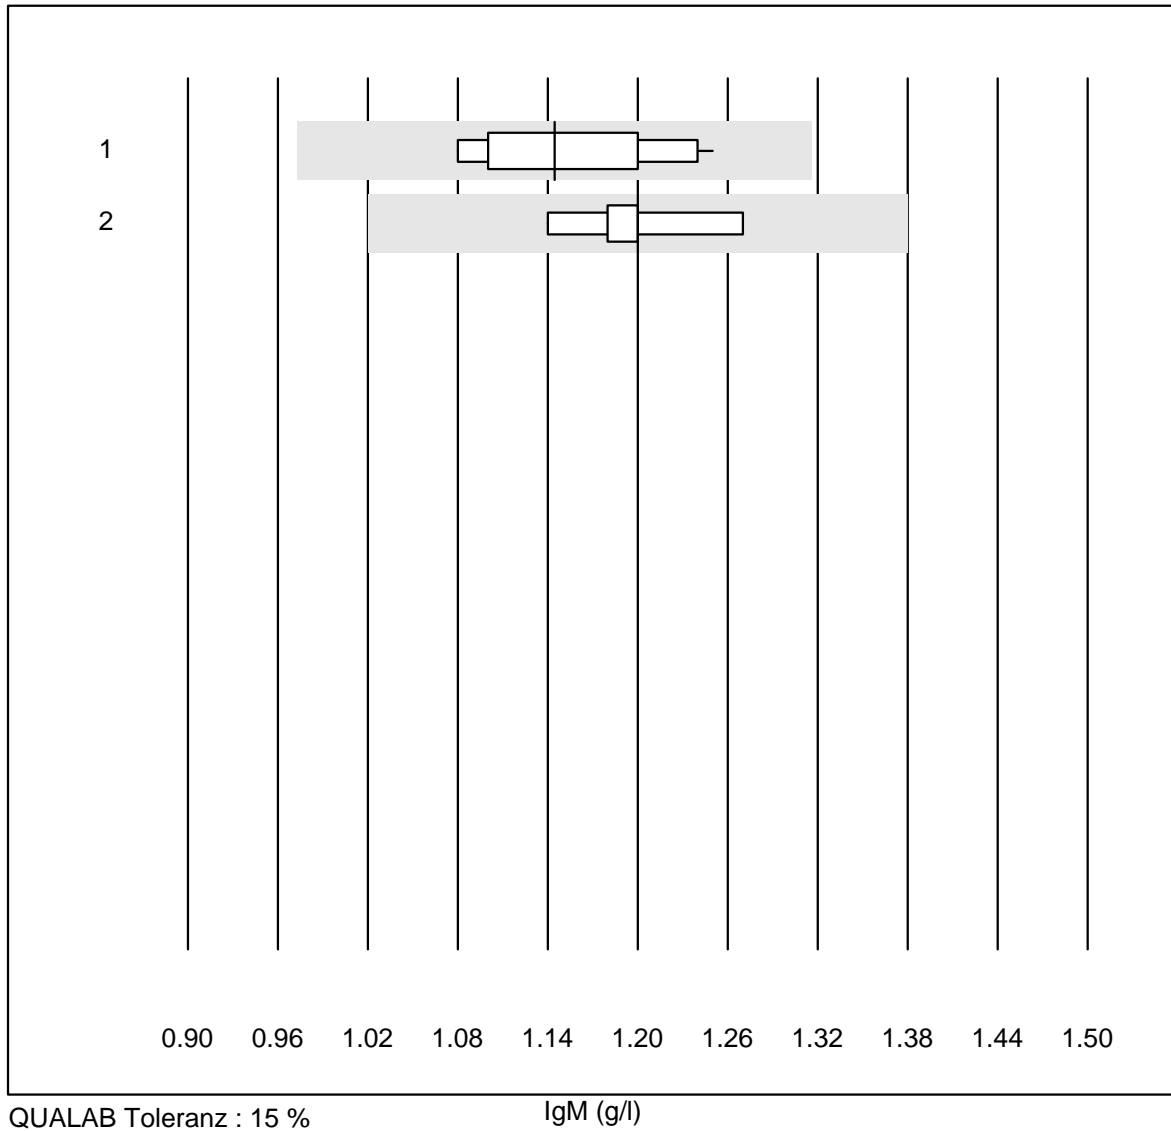


QUALAB Toleranz : 15 %

IgM (g/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Turbidimetrie	16	100.0	0.0	0.0	1.14	5.2	e
2 Nephelometrie	5	100.0	0.0	0.0	1.20	3.9	e

IgE

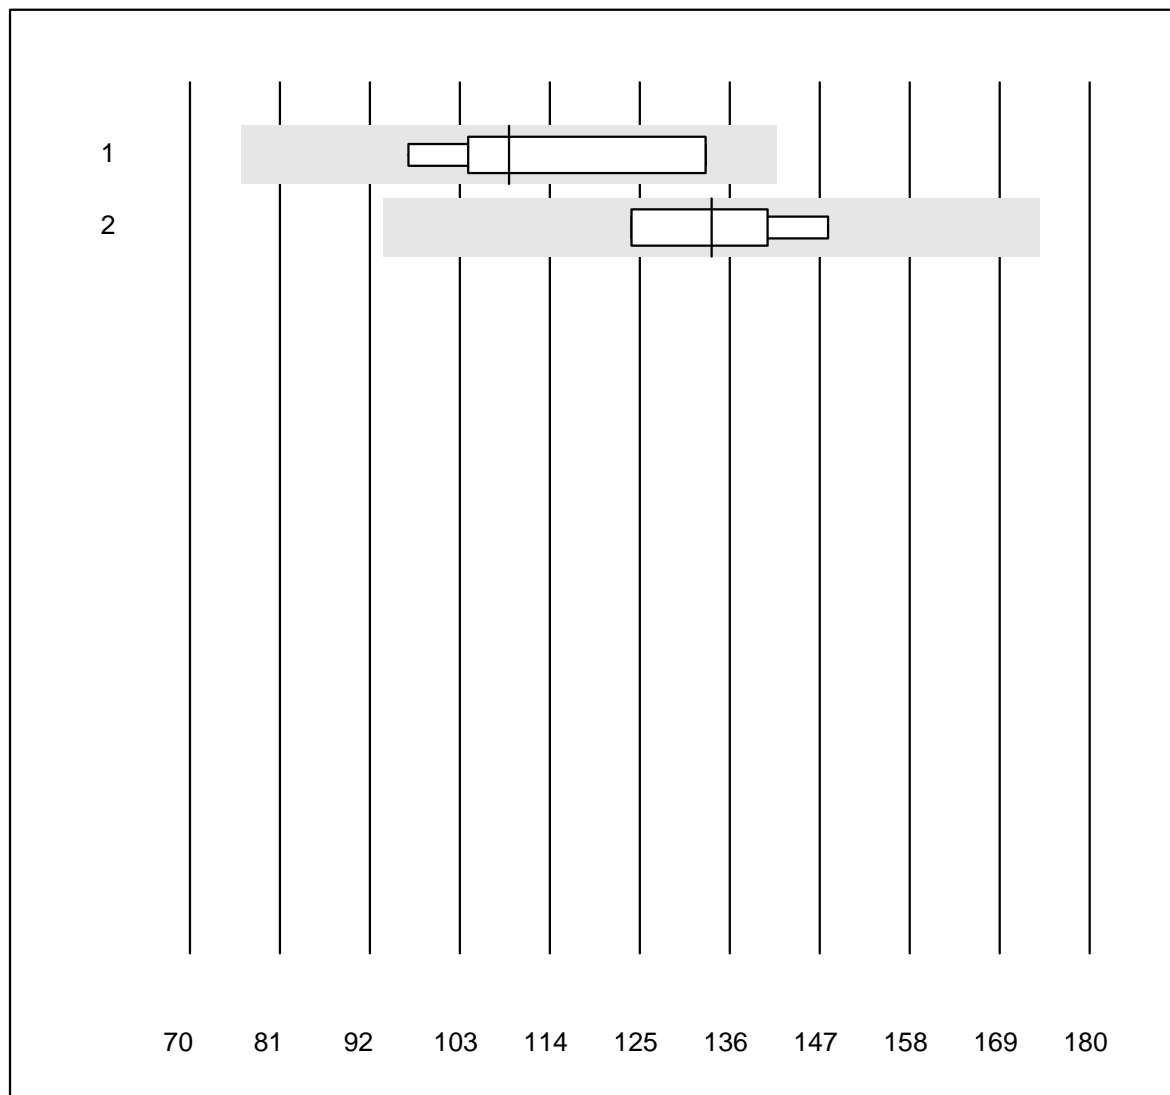


QUALAB Toleranz : 30 %

IgE (kU/L)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	109	12.8	e*
2 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	134	8.4	e*

Alpha-1-Antitrypsine

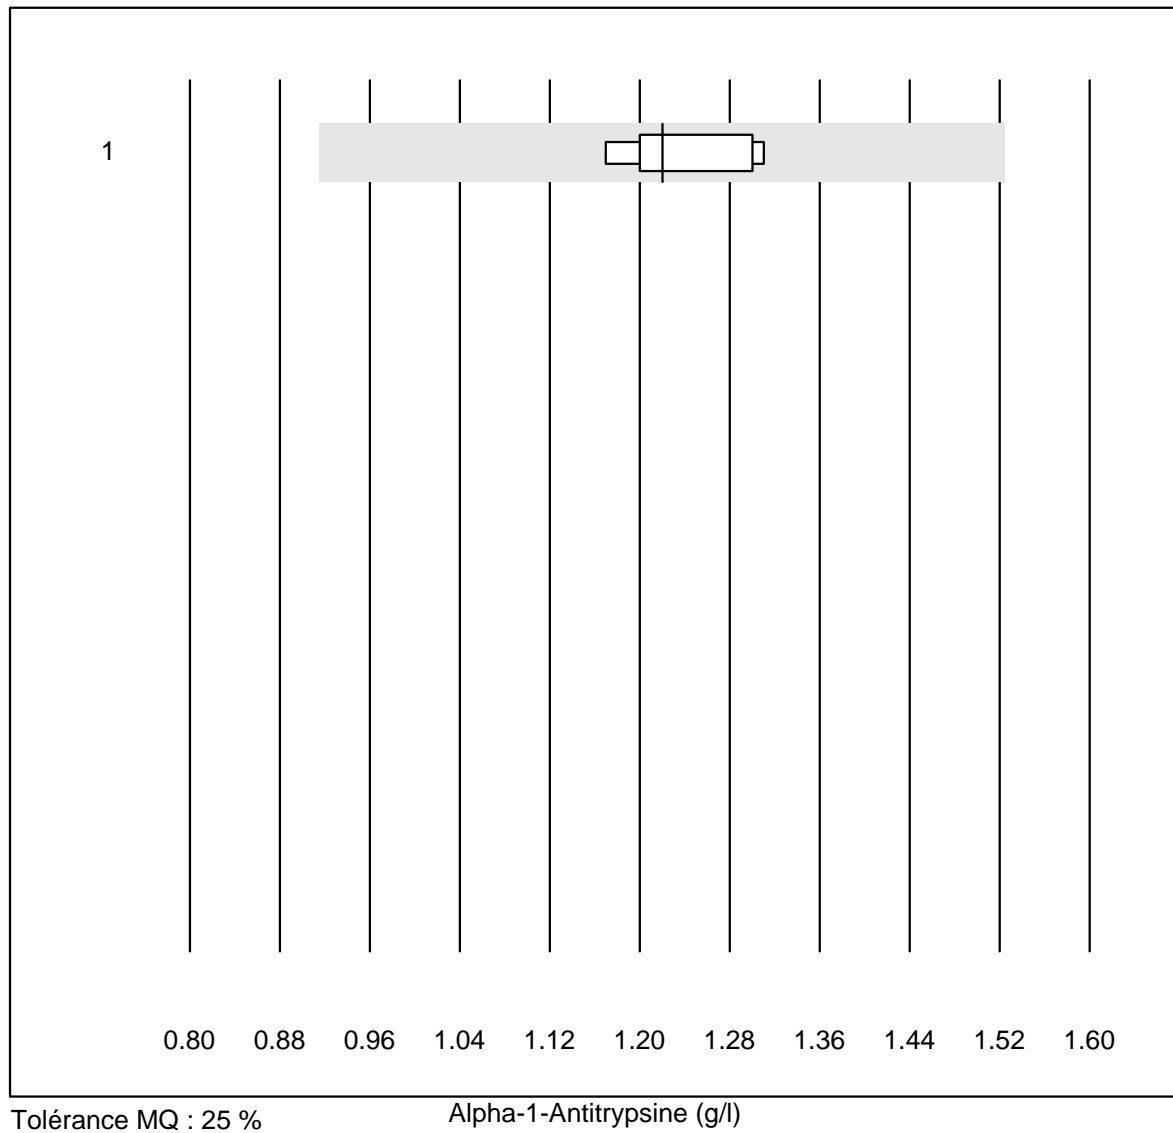

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	9	100.0	0.0	0.0	1.22	4.3	e

Anti-Streptolysine-Anticorps

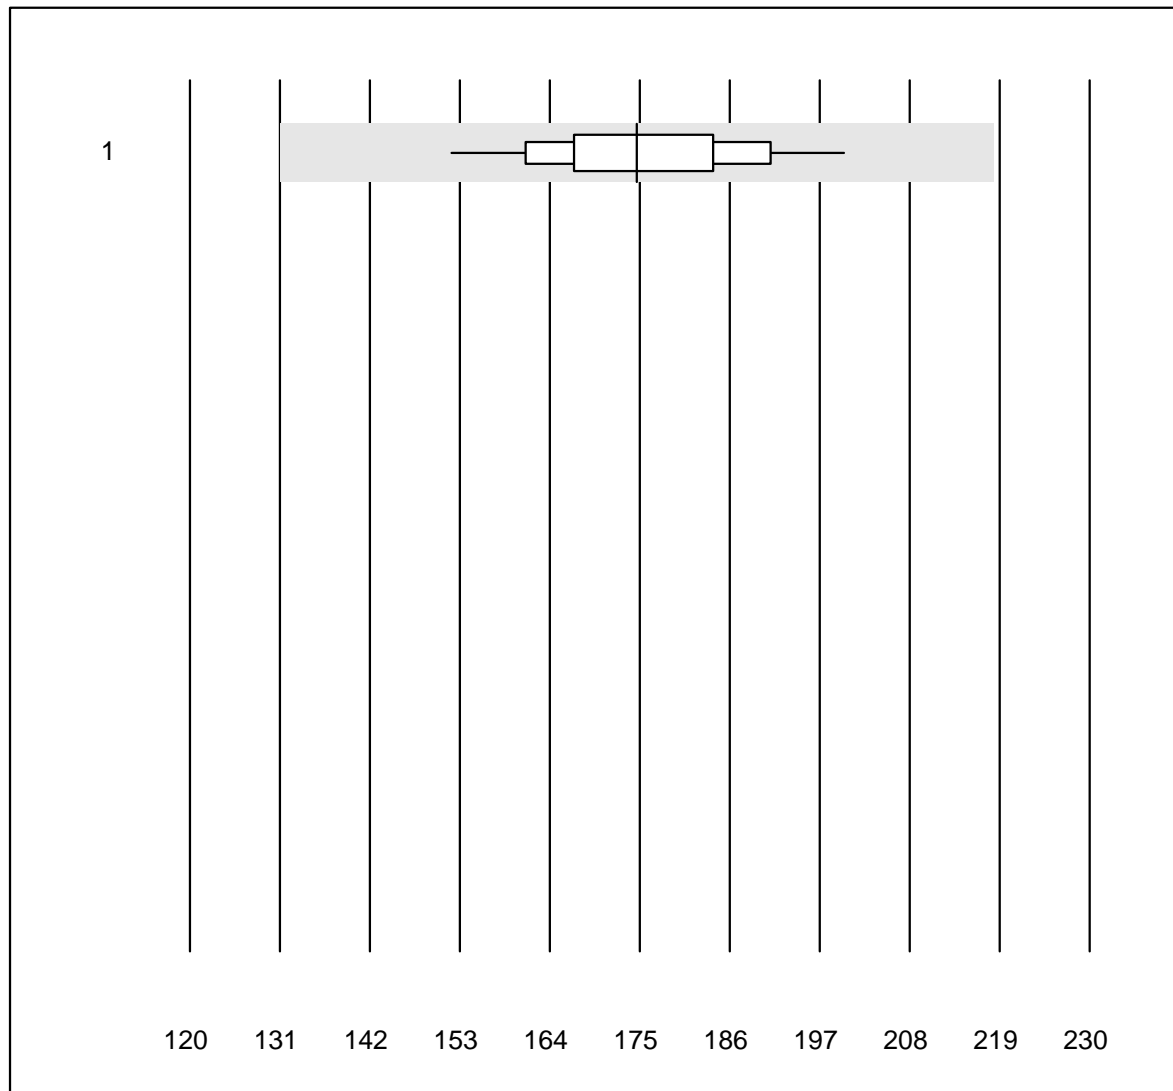


Tolérance MQ : 25 %

Anti-Streptolysine-Anticorps (kIU/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	13	100.0	0.0	0.0	175	7.7	e

Complément C3

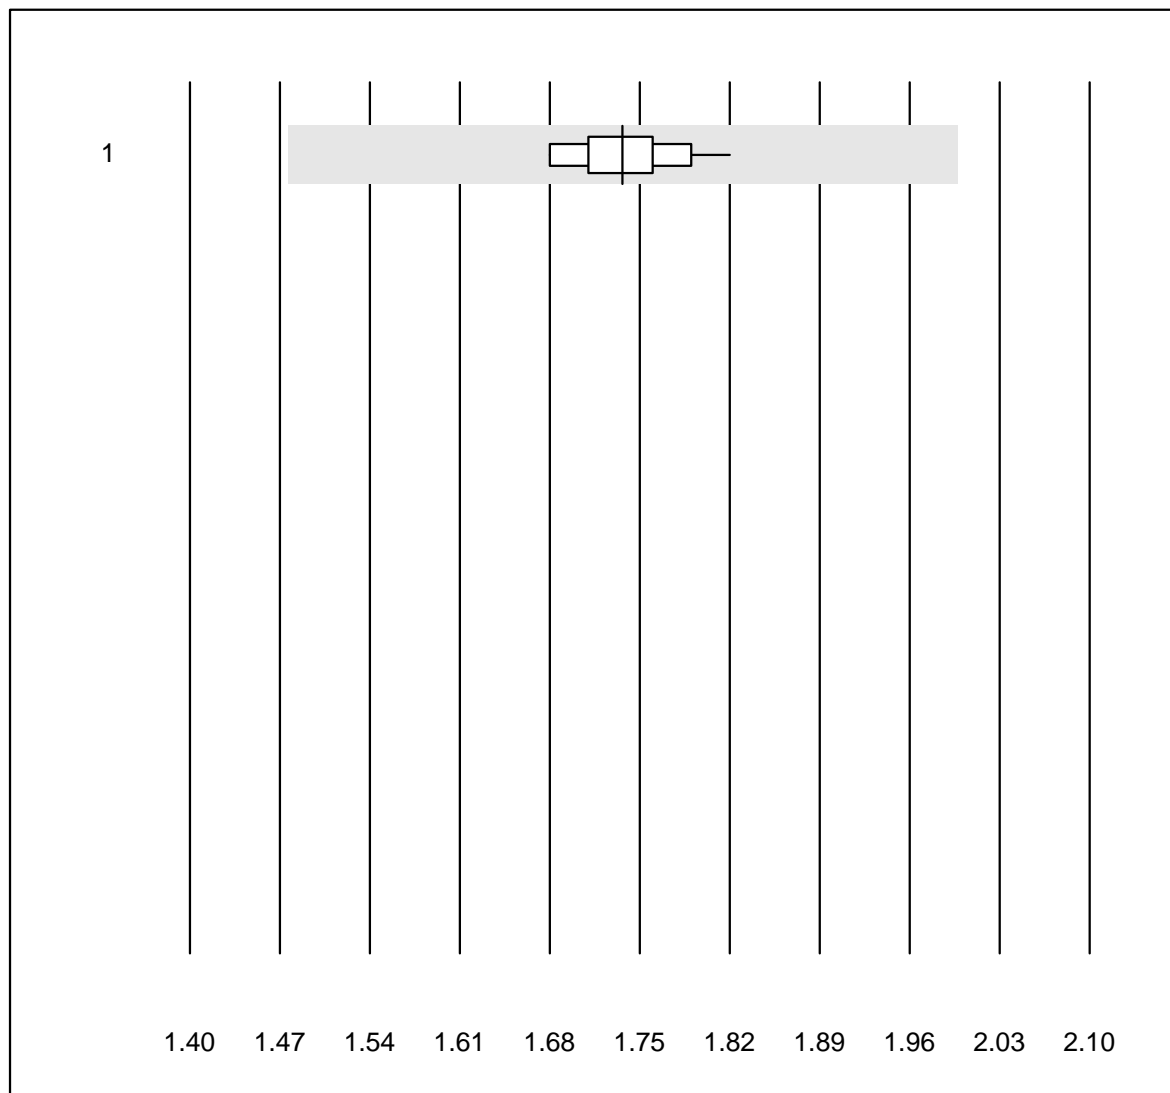


QUALAB Toleranz : 15 %

Complément C3 (g/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	15	100.0	0.0	0.0	1.74	2.3	e

Complément C4

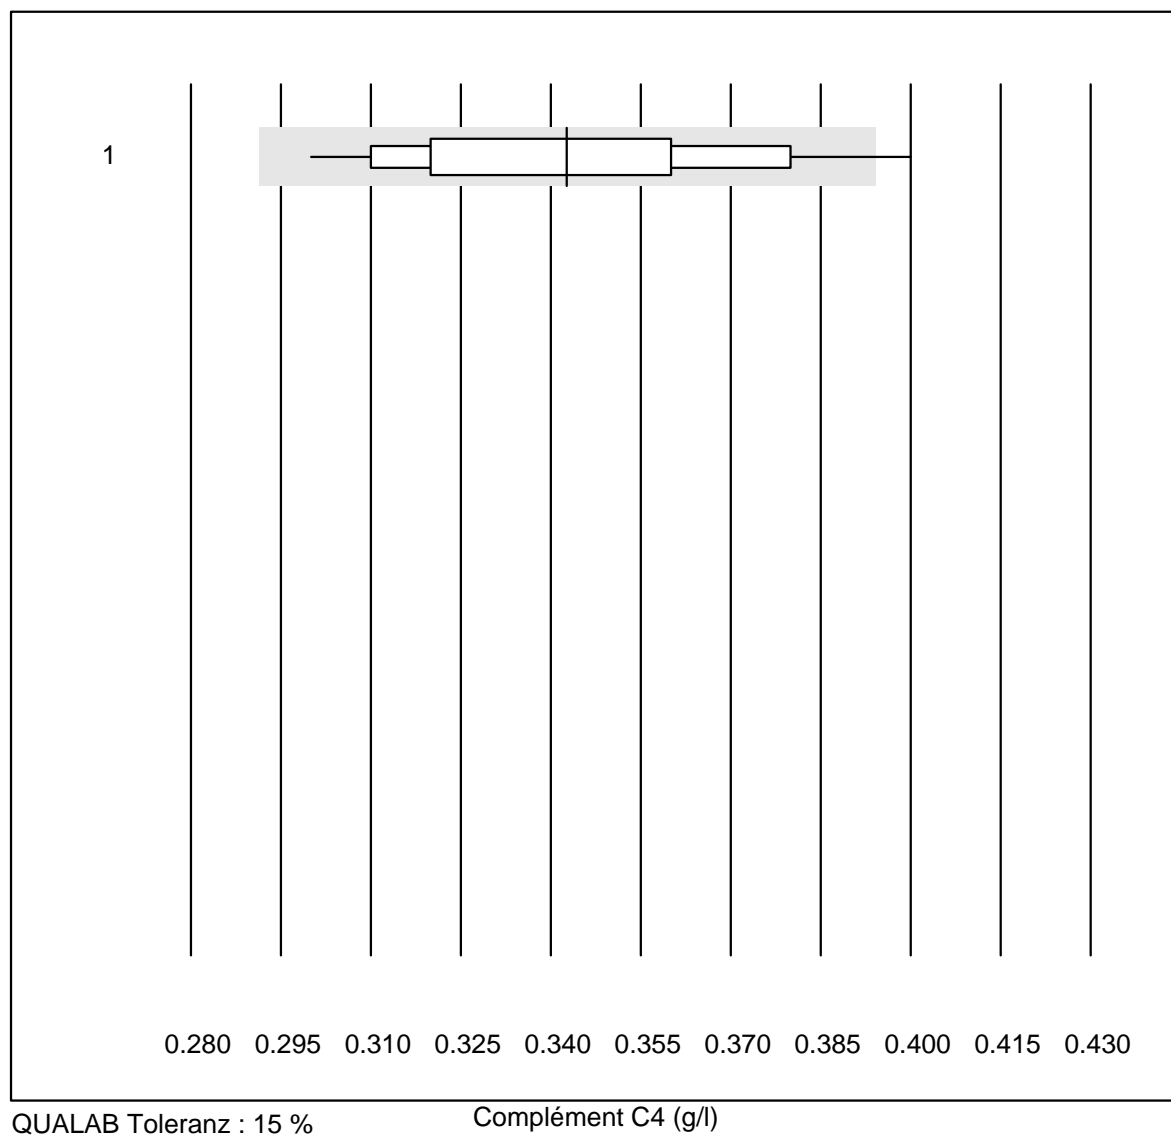


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	16	93.7	6.3	0.0	0.34	8.6	e*

Haptoglobine

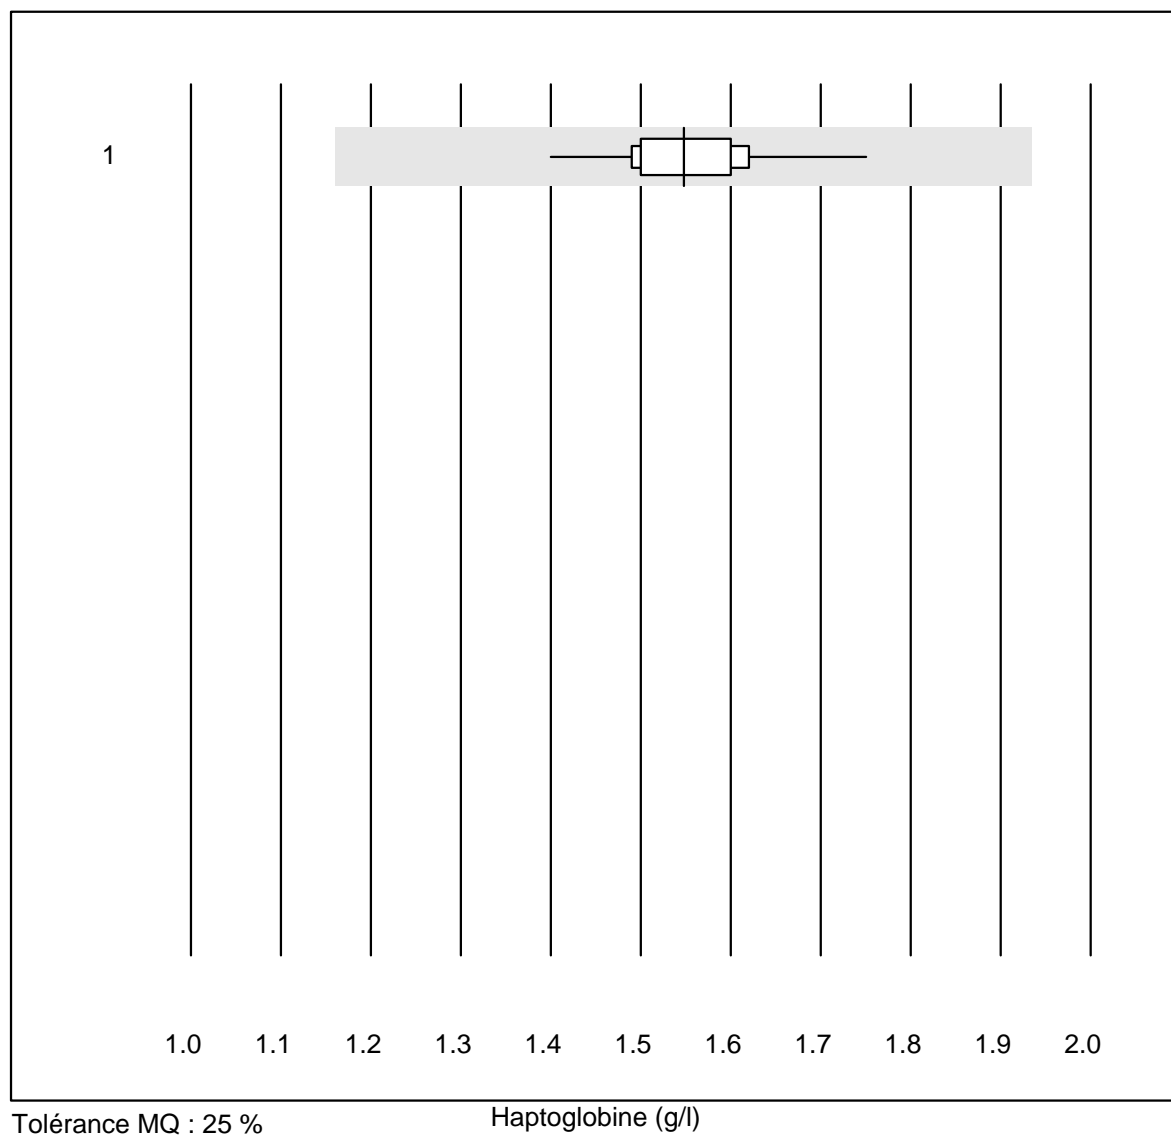


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	22	100.0	0.0	0.0	1.55	4.7	e

Transferrine

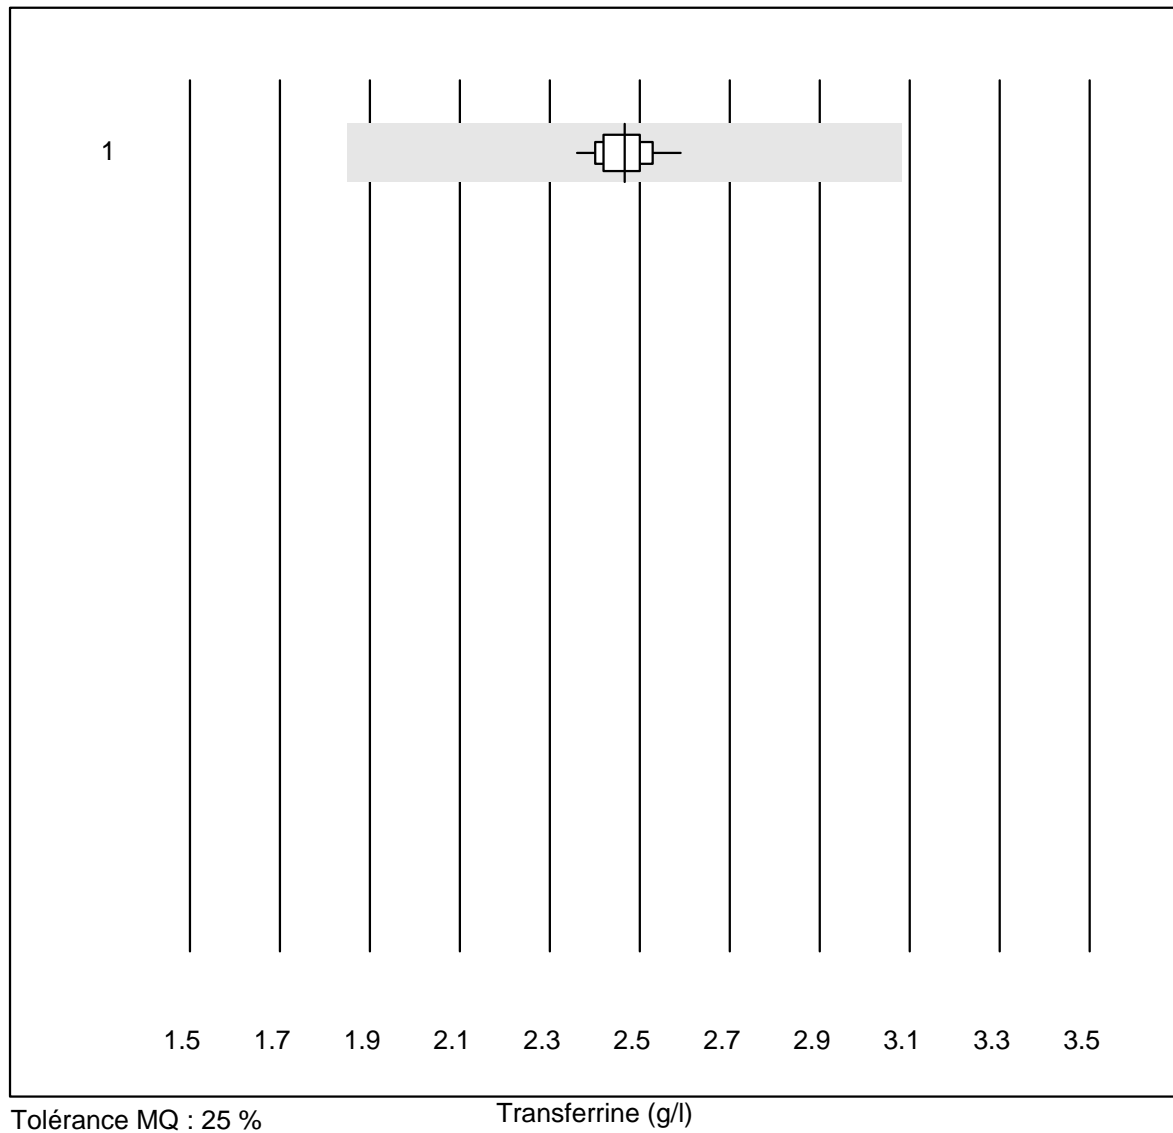


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	26	100.0	0.0	0.0	2.47	2.4	e

Bêta-2 microglobuline

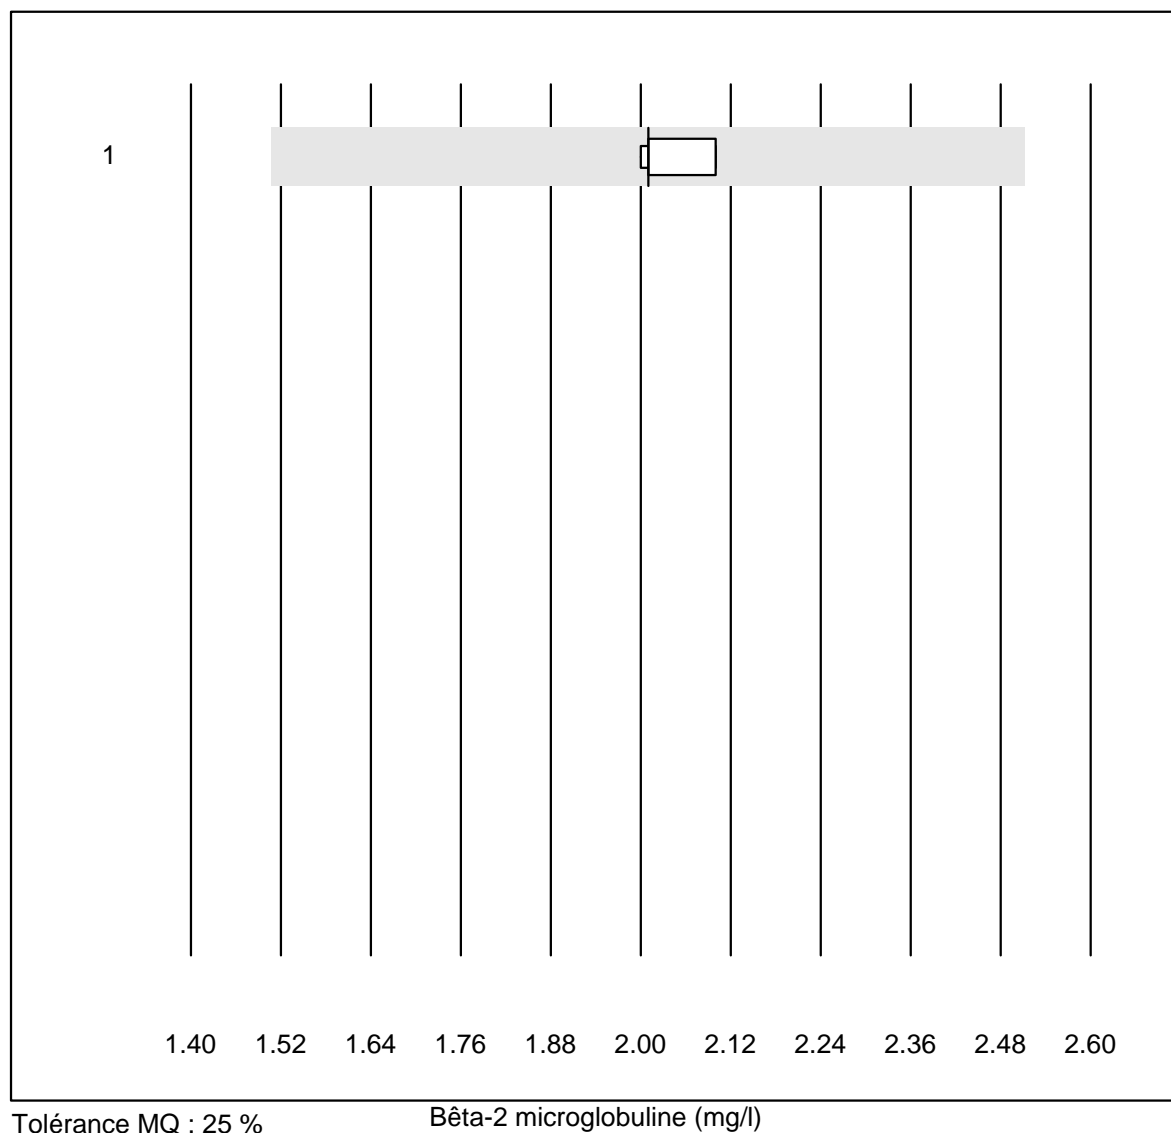


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	2.01	2.5	e

Facteur rhumatoïde

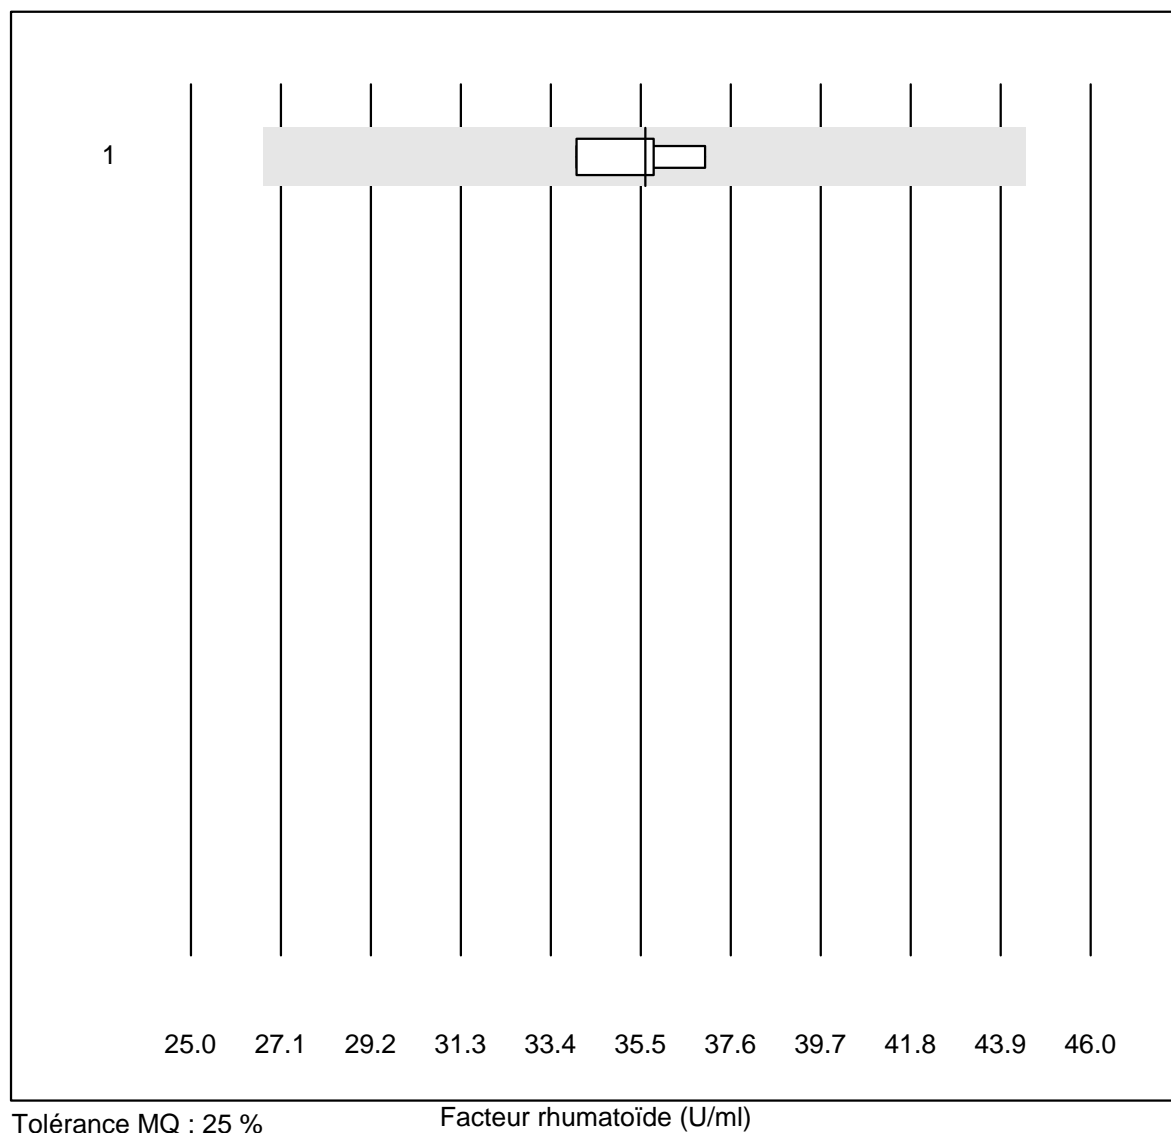


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Architect	4	100.0	0.0	0.0	35.6	3.9	a

Céruleplasmine

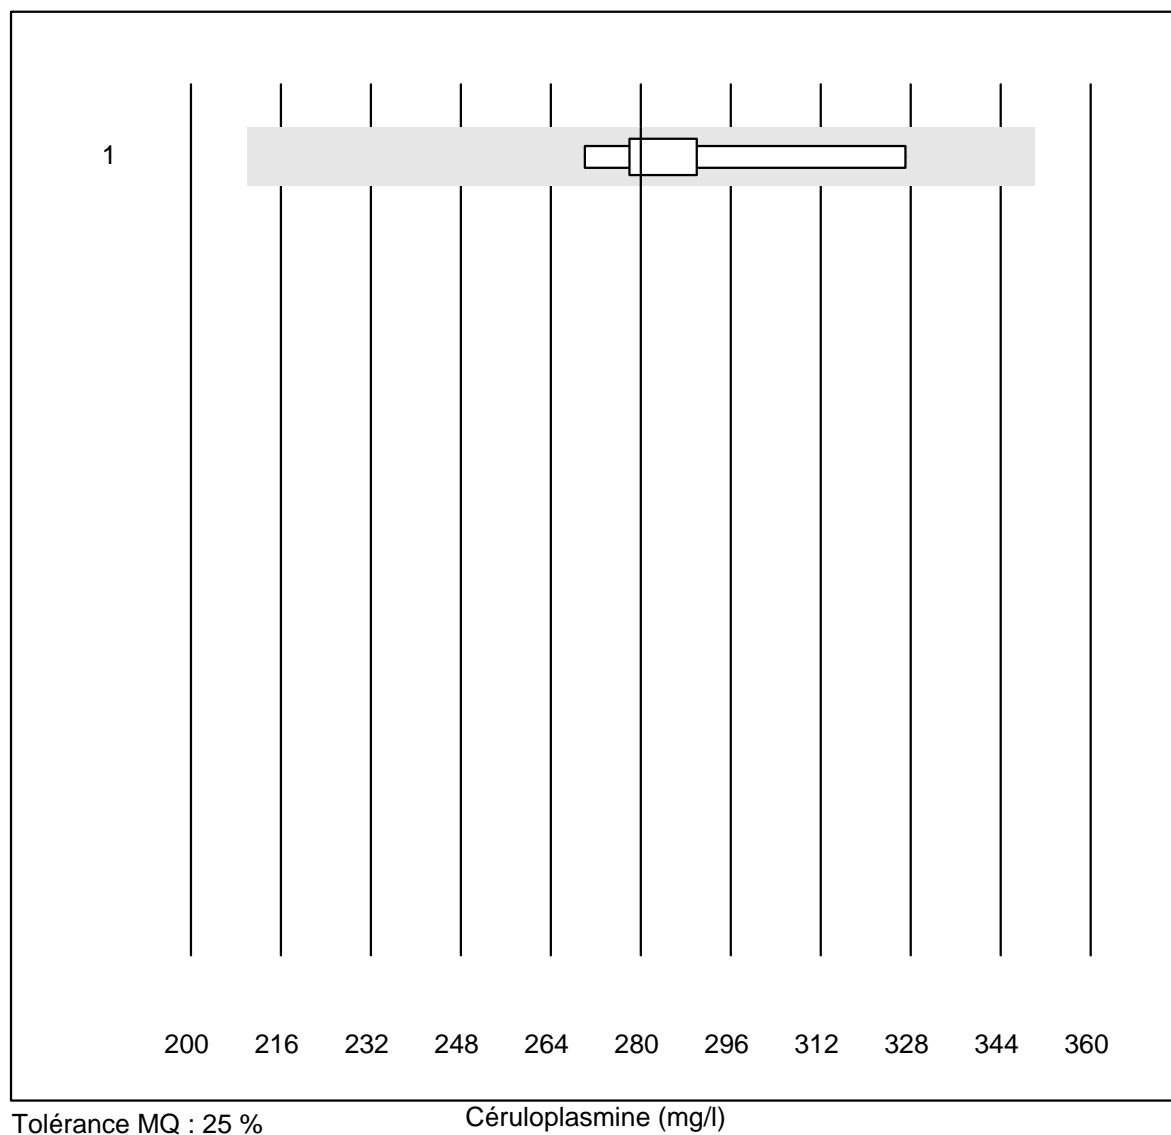

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	280.00	7.1	e

Pré-albumine

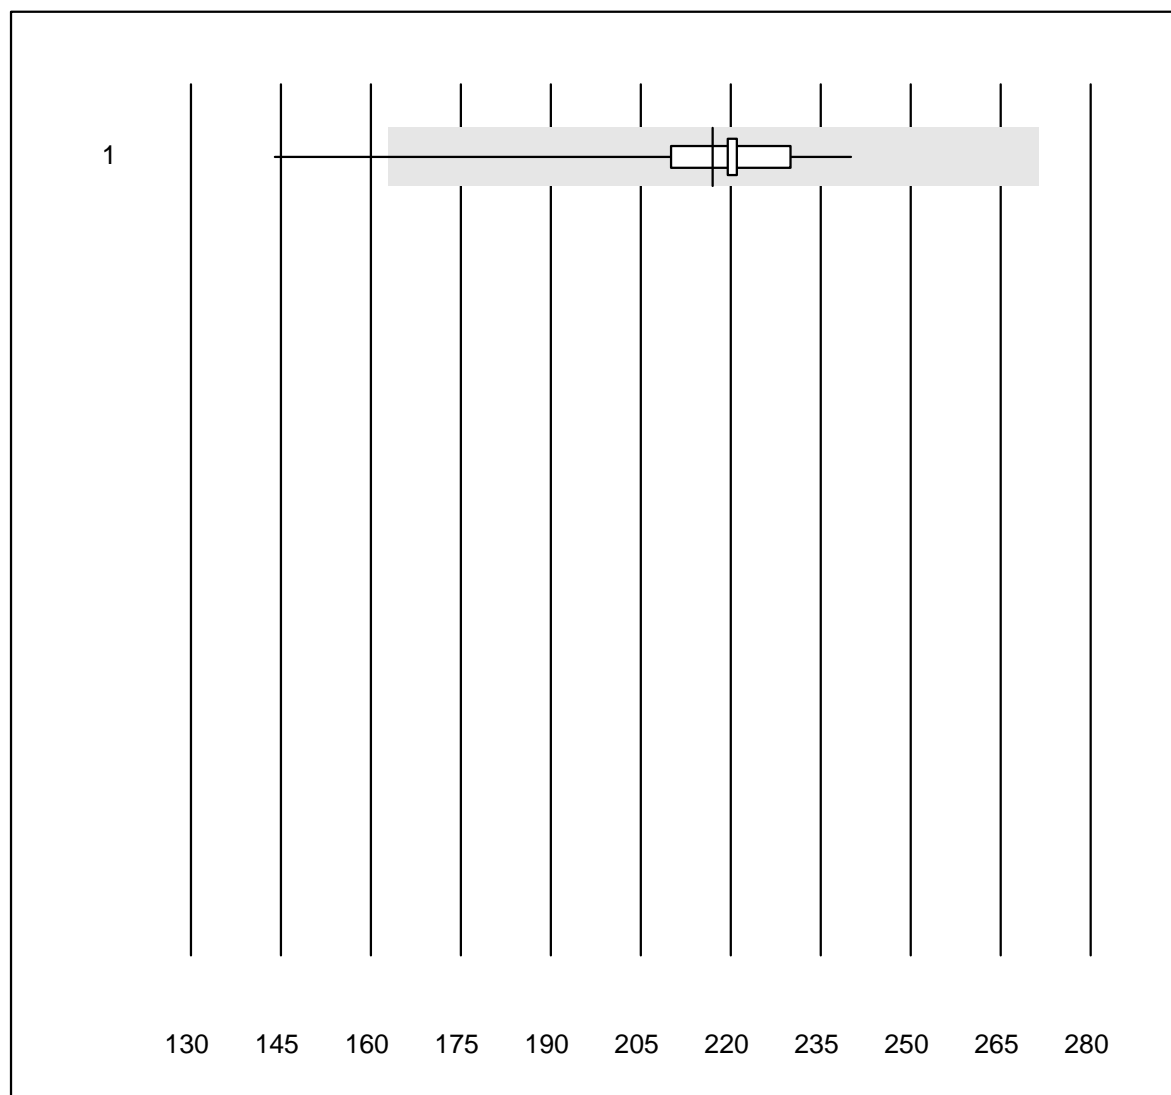


Tolérance MQ : 25 %

Pré-albumine (mg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	16	93.7	6.3	0.0	217.0	9.5	e

Récepteur soluble de la transferrine

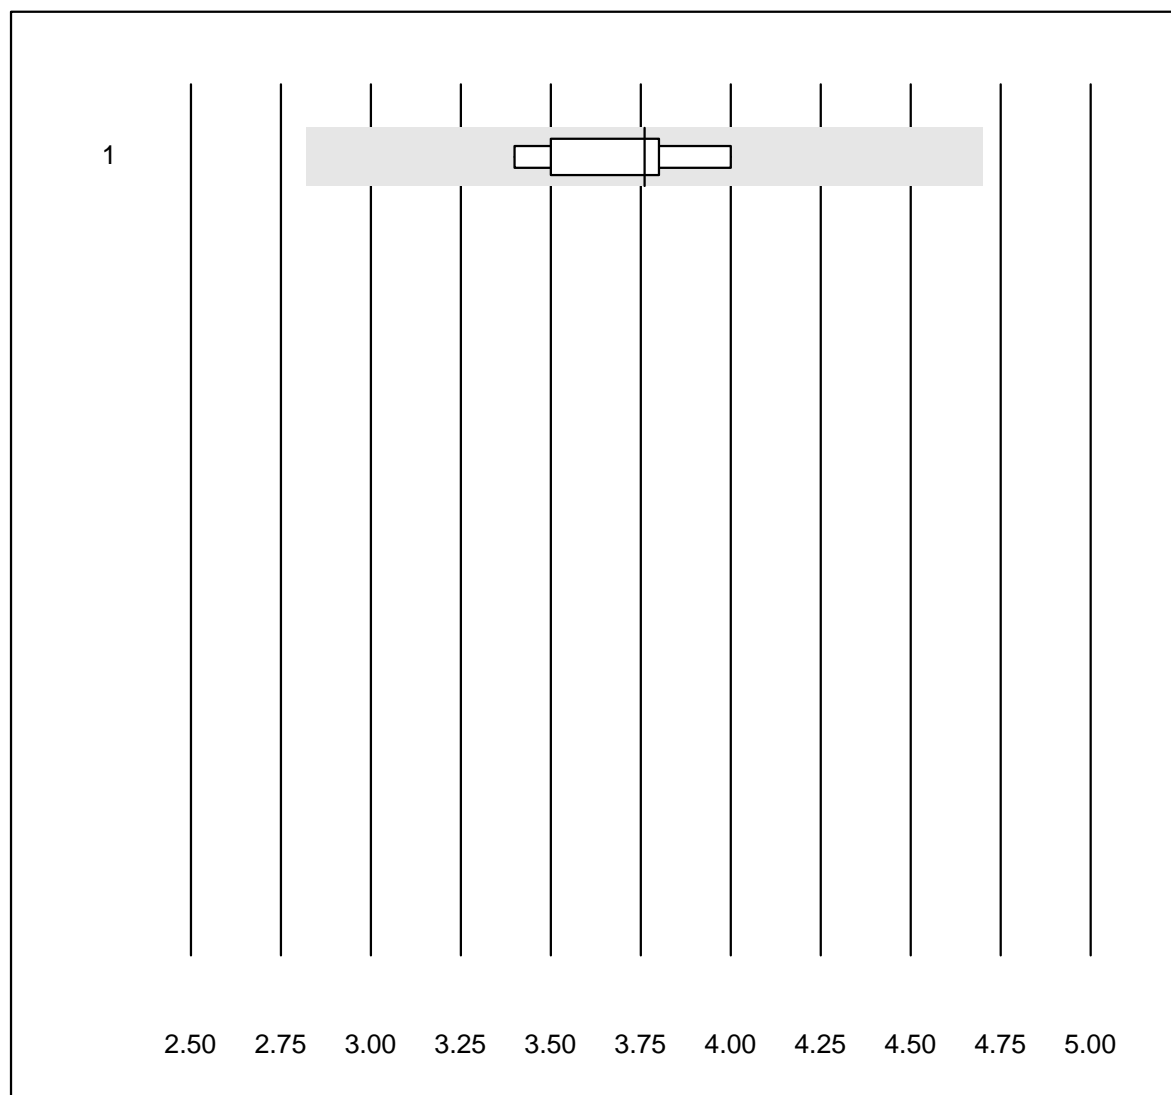


Tolérance MQ : 25 %

Récepteur soluble de la transferrine (mg/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	8	100.0	0.0	0.0	3.8	5.3	e


chaînes légères libres Kappa

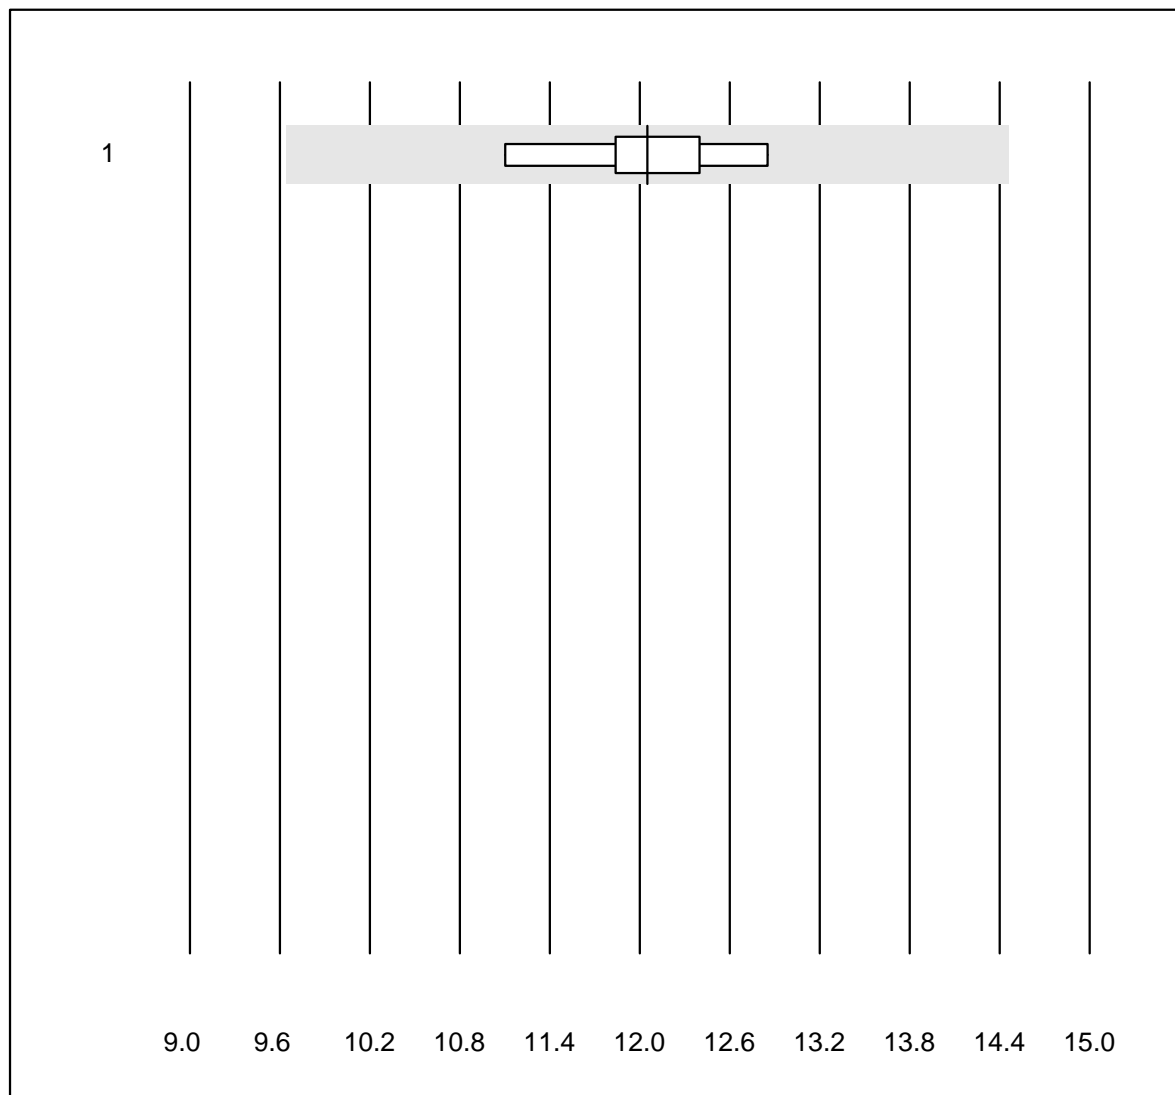

QUALAB Toleranz : 20 % chaînes légères libres Kappa (mg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	12	4.5	e

chaîne légère Lambda

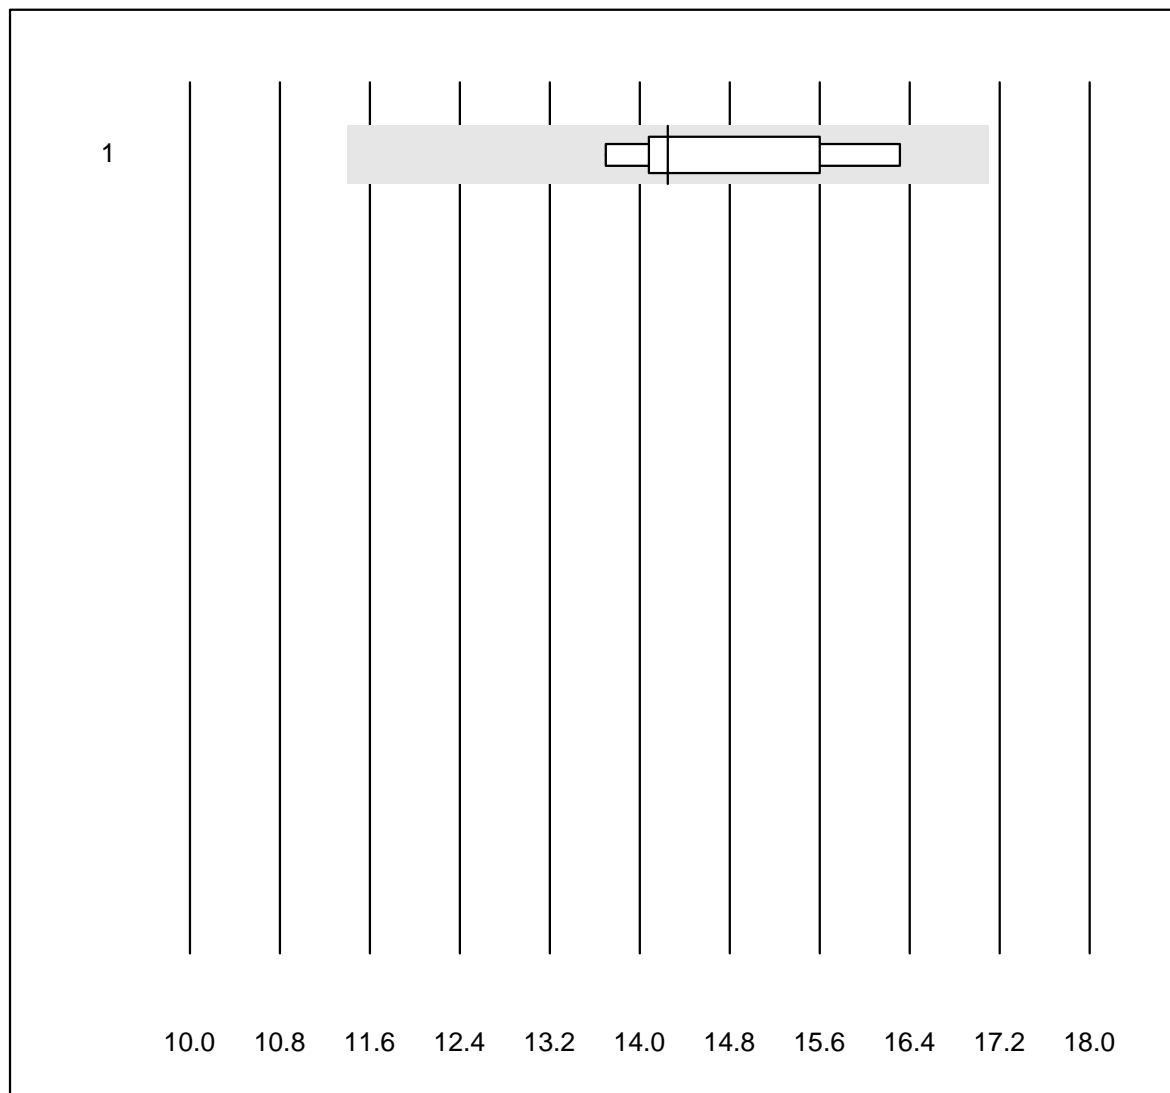


QUALAB Toleranz : 20 %

chaîne légère Lambda (mg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	14	6.4	e*

CRP HS

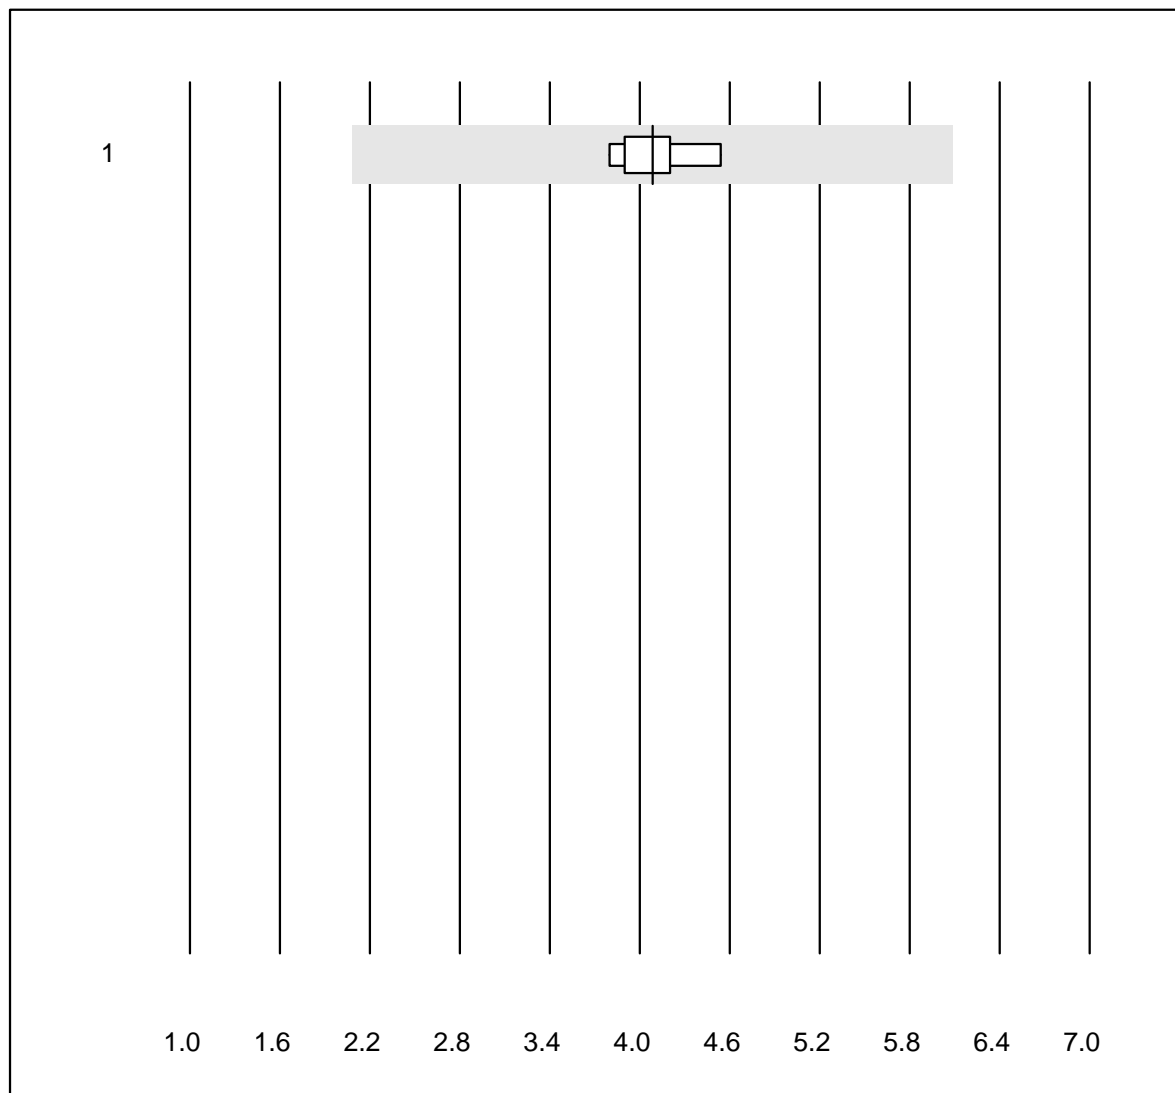


QUALAB Toleranz : 21 %
 (< 10.00: +/- 2.00 mg/l)

CRP HS (mg/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Turbidimetrie	6	100.0	0.0	0.0	4.09	6.3	e*

CRP

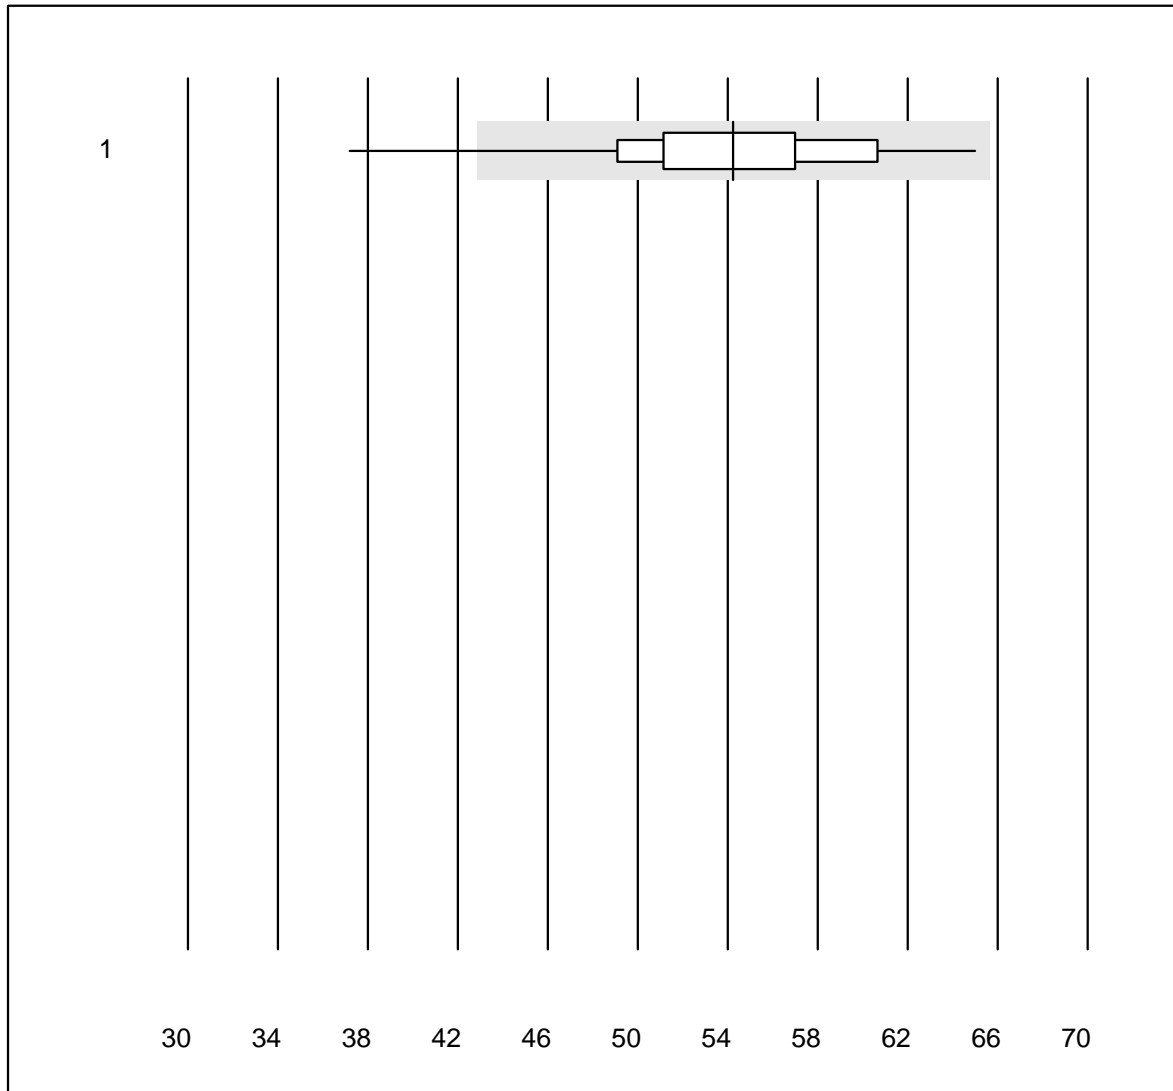


QUALAB Toleranz : 21 %

CRP (mg/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 AFIAS	120	90.8	2.5	6.7	54.2	9.0	e

Anti deam. Gliadin IgG

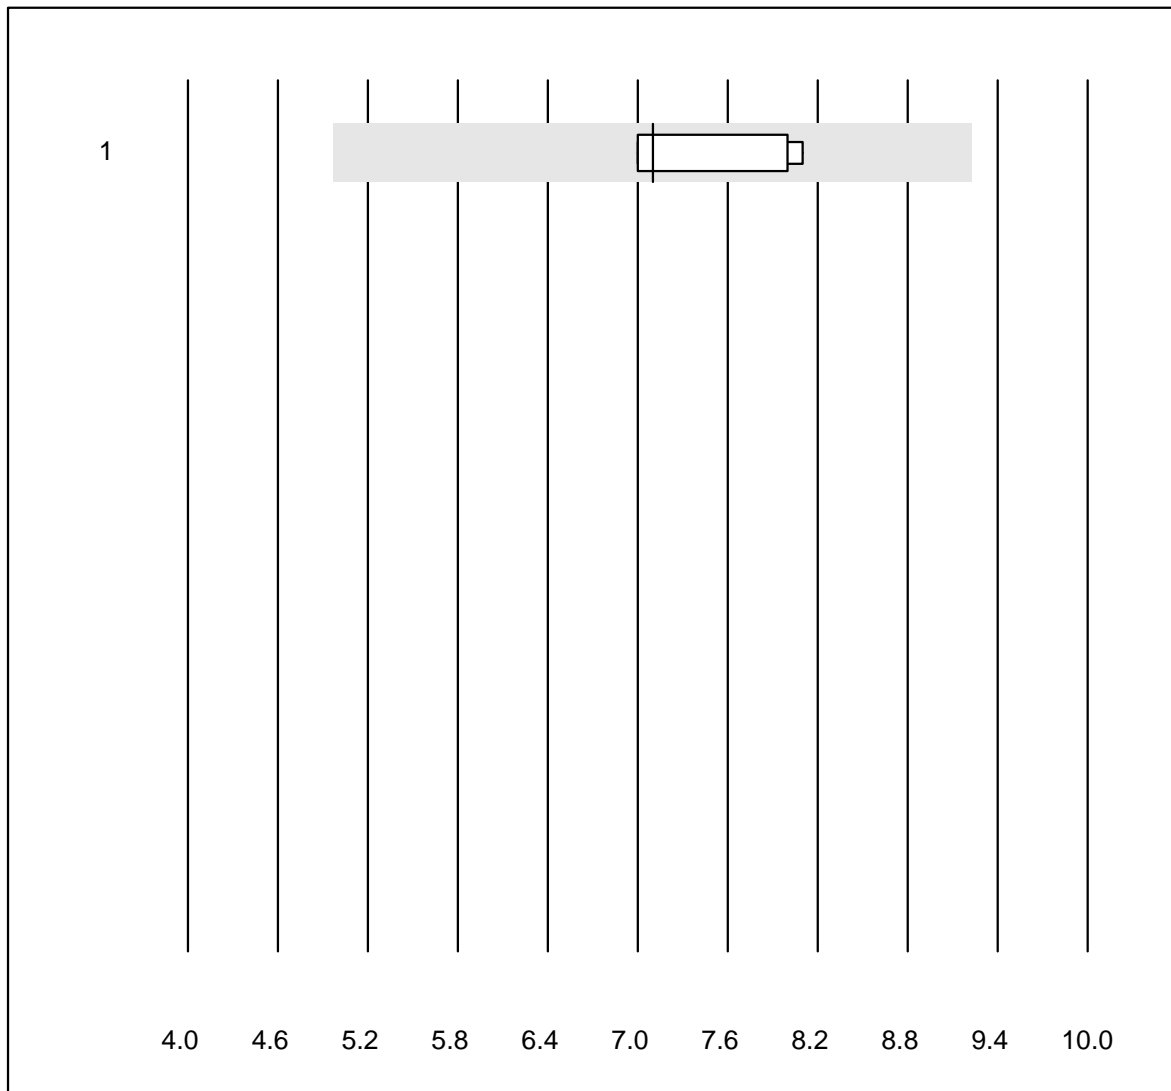


Tolérance MQ : 30 %

Anti deam. Gliadin IgG (U/ml)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Autres méthodes	6	100.0	0.0	0.0	7.10	7.1	e

Anti deam. Gliadin IgA

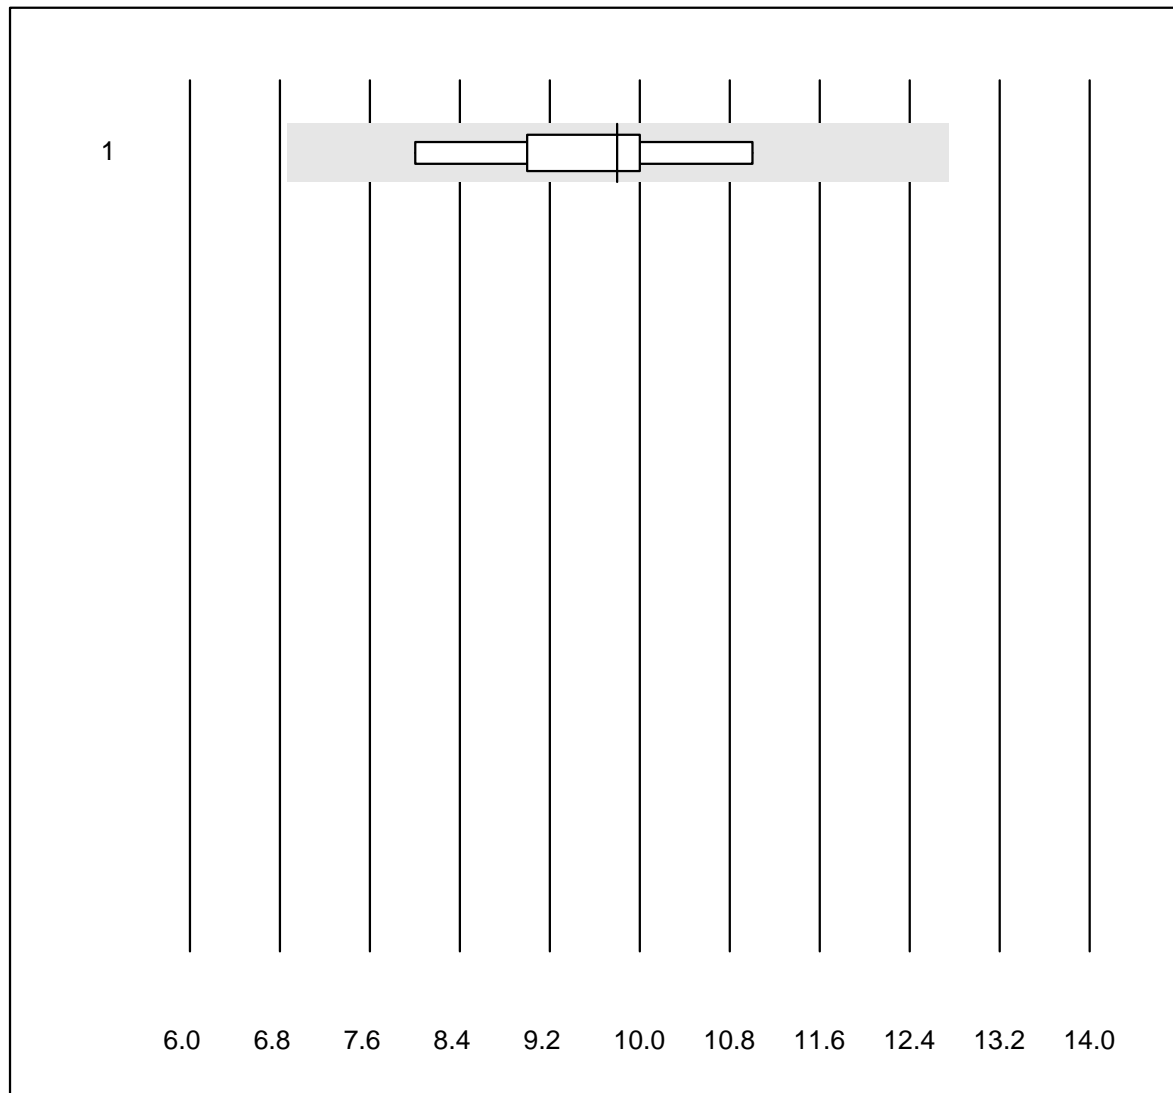


Tolérance MQ : 30 %

Anti deam. Gliadin IgA (U/ml)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Autres méthodes	6	100.0	0.0	0.0	9.80	10.6	e*

Anti tTG IgA

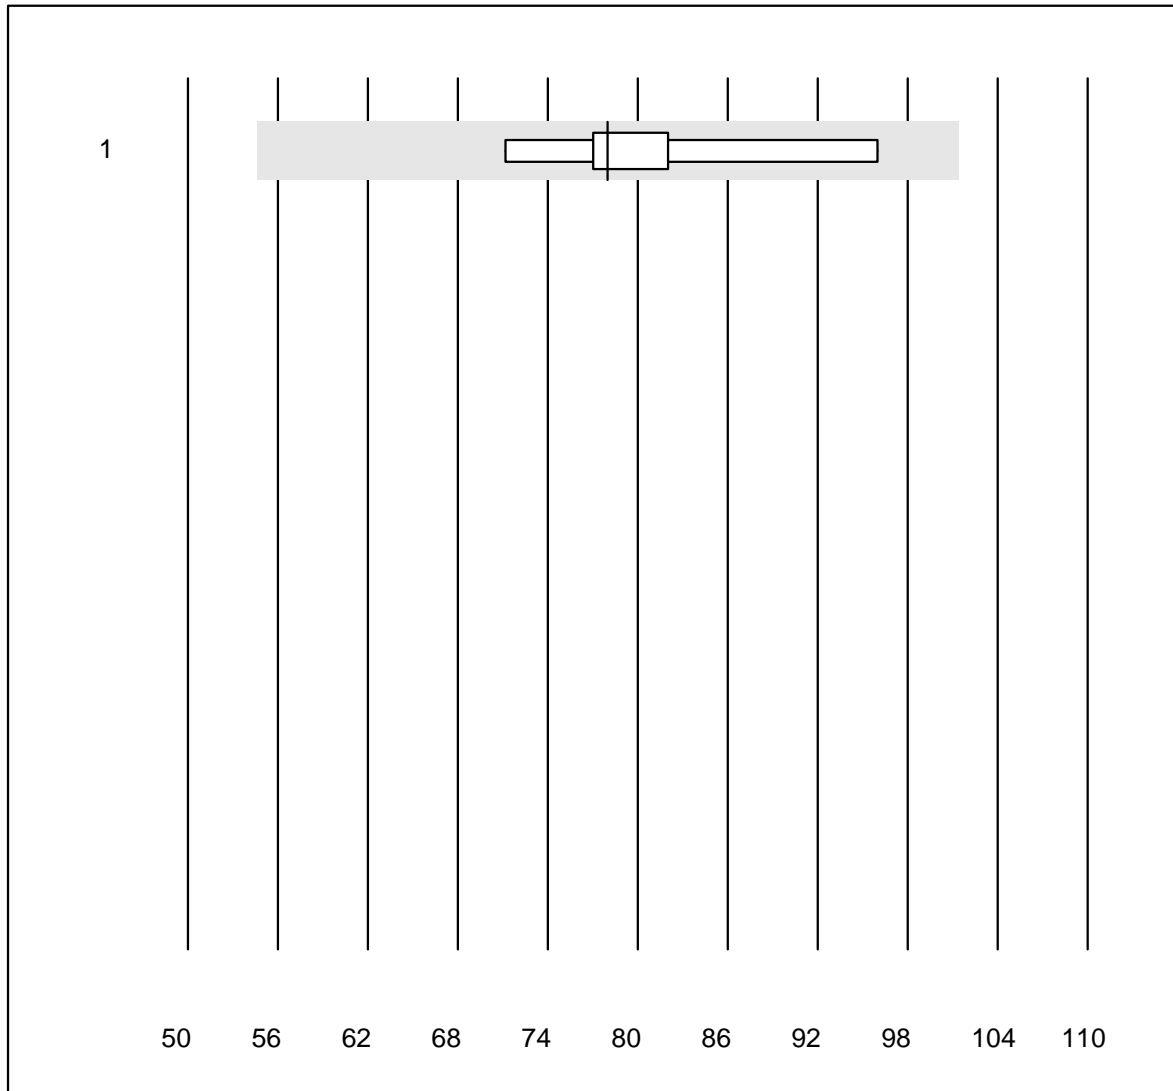


Tolérance MQ : 30 %

Anti tTG IgA (U/ml)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Autres méthodes	6	100.0	0.0	0.0	78.00	10.5	e*

Albumine

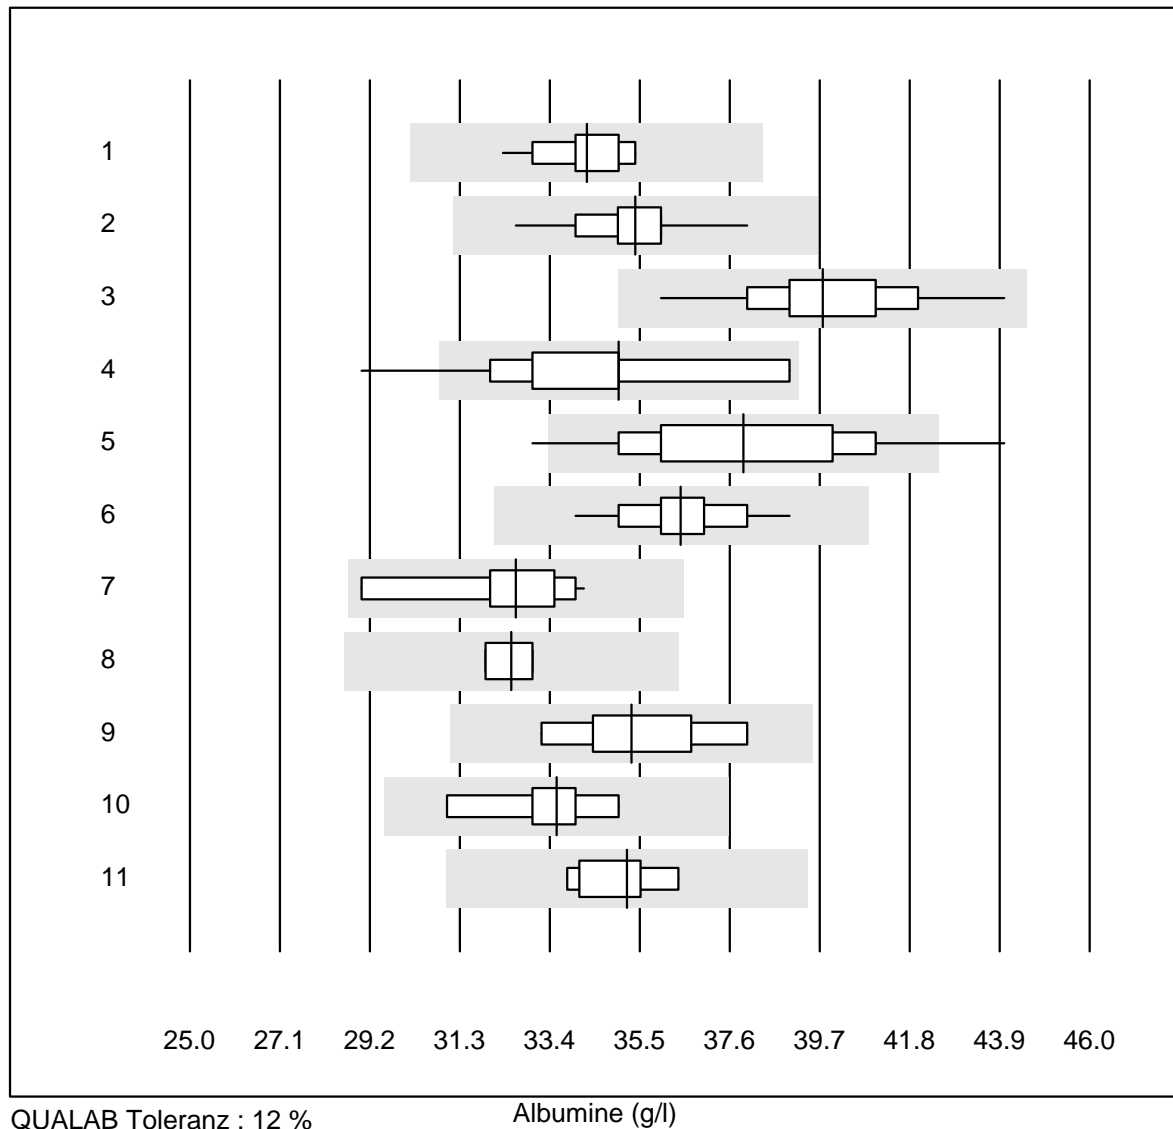


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	12	100.0	0.0	0.0	34	2.8	e
2	Cobas	21	100.0	0.0	0.0	35	3.2	e
3	Fuji Dri-Chem	227	99.6	0.0	0.4	40	3.8	e
4	Spotchem/Ready	28	92.9	7.1	0.0	35	7.0	e
5	Spotchem D-Concept	168	94.6	4.8	0.6	38	6.2	e
6	Piccolo	53	98.1	0.0	1.9	36	2.9	e
7	Beckmann	10	100.0	0.0	0.0	33	4.5	e
8	Dimension	4	100.0	0.0	0.0	33	1.9	e
9	Abx Mira	6	100.0	0.0	0.0	35	4.9	e*
10	Hitachi S40/M40	10	90.0	0.0	10.0	34	3.4	e
11	Autolyser/DiaSys	7	100.0	0.0	0.0	35	2.6	e

Phosphatase alkaline

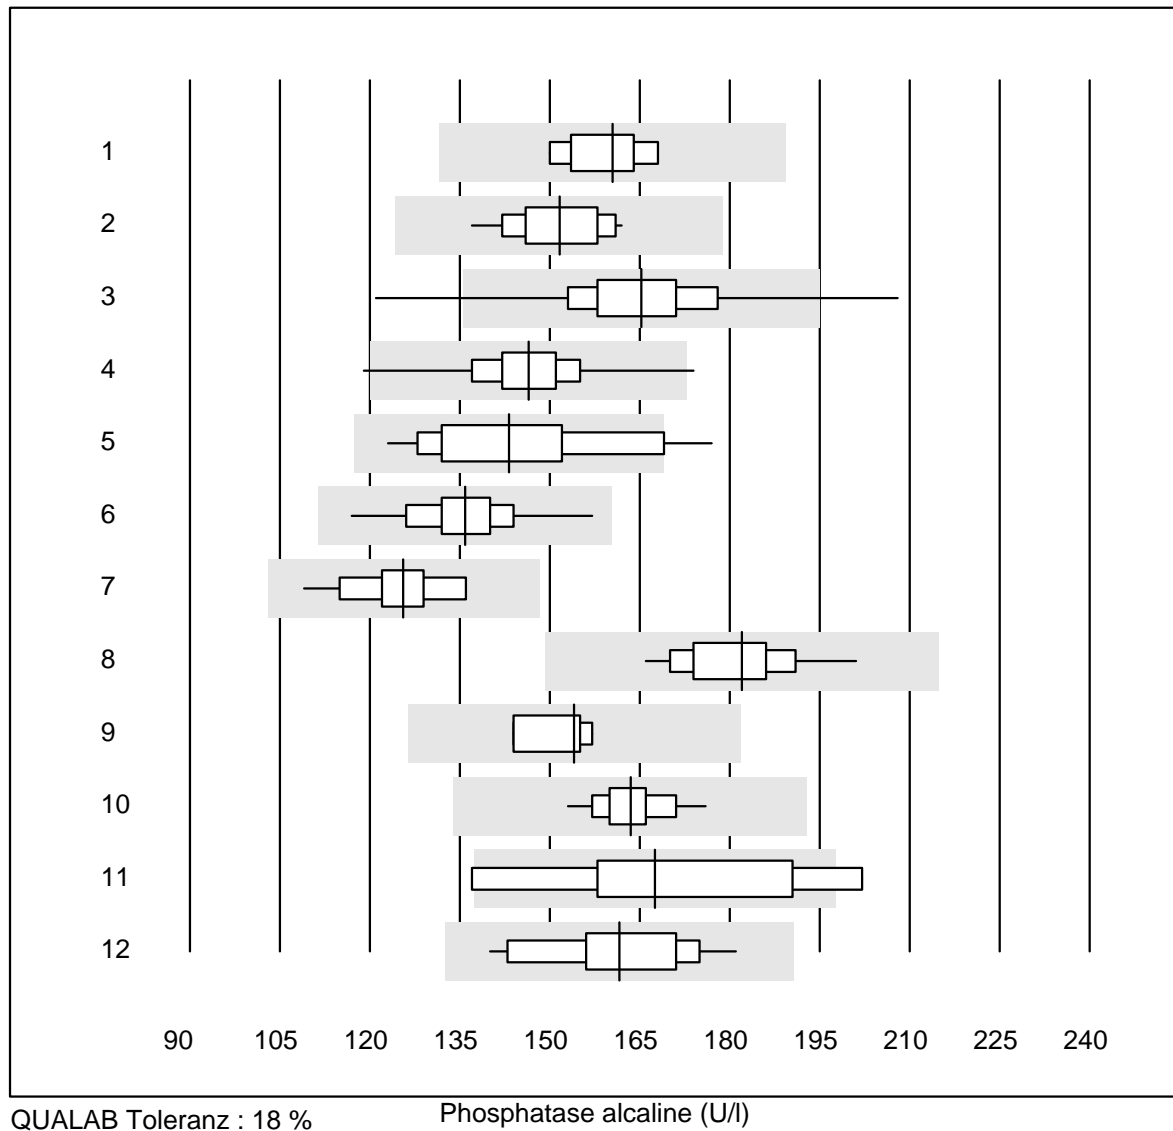


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	8	100.0	0.0	0.0	161	3.8	e
2 Cobas	22	100.0	0.0	0.0	152	4.9	e
3 Reflotron	438	97.5	1.8	0.7	165	6.4	e
4 Fuji Dri-Chem	825	99.4	0.2	0.4	146	4.9	e
5 Spotchem/Ready	50	86.0	8.0	6.0	143	10.1	e
6 Spotchem D-Concept	320	99.1	0.0	0.9	136	5.1	e
7 Hitachi S40/M40	14	100.0	0.0	0.0	126	6.0	e
8 Beckman	12	100.0	0.0	0.0	182	5.4	e
9 Dimension	4	100.0	0.0	0.0	154	3.8	e
10 Piccolo	44	100.0	0.0	0.0	163	3.3	e
11 Abx Mira	8	62.5	25.0	12.5	168	12.9	e*
12 Autolyser/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	162	6.8	e

Amylase

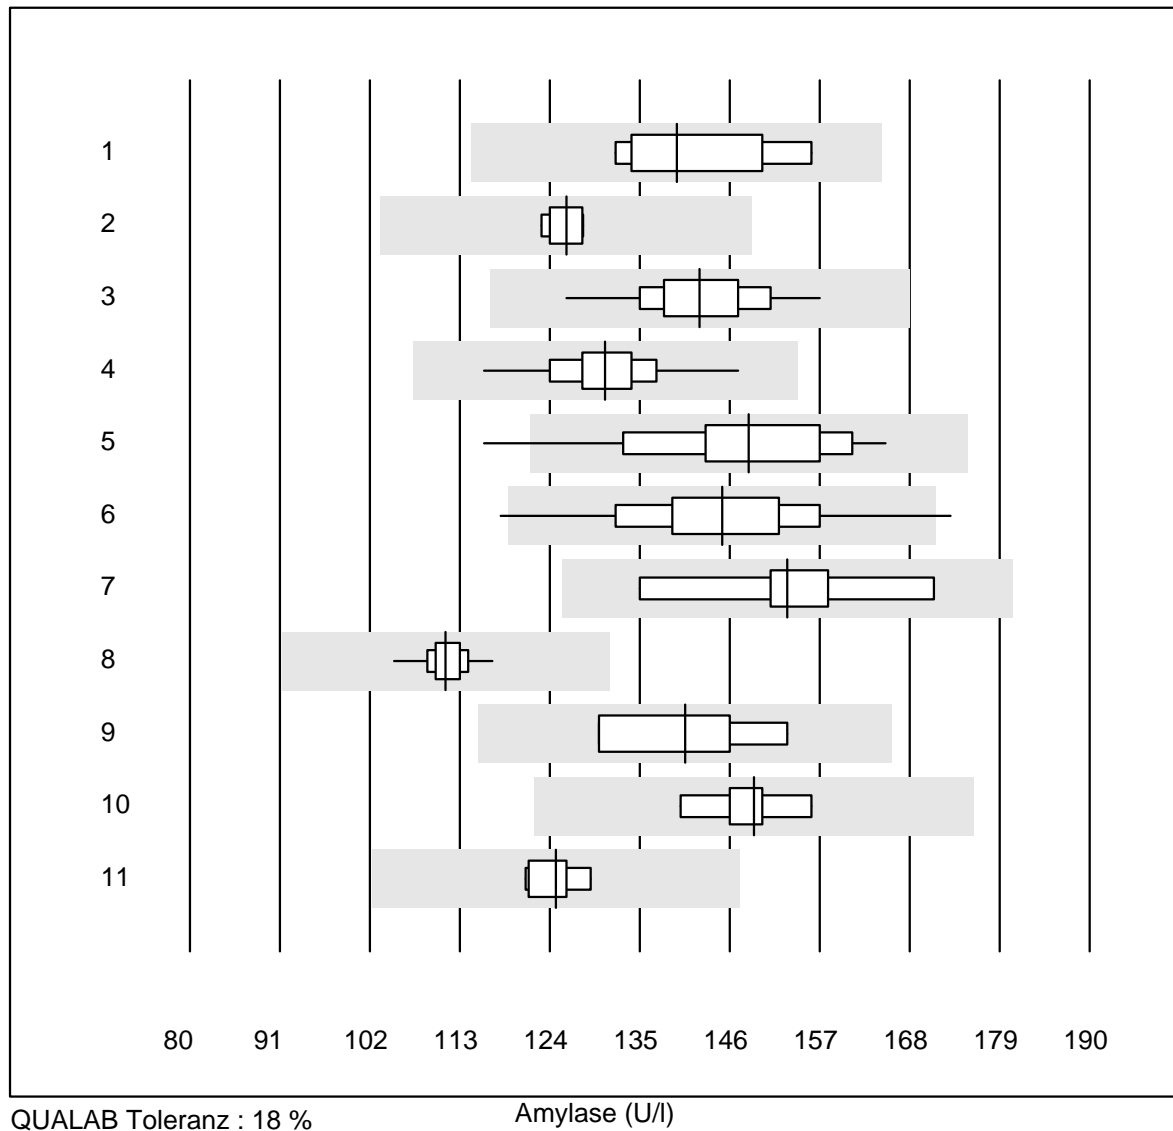


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	8	100.0	0.0	0.0	140	6.3	e*
2 Cobas	8	100.0	0.0	0.0	126	1.6	e
3 Reflotron	111	99.1	0.0	0.9	142	4.3	e
4 Fuji Dri-Chem	607	99.8	0.0	0.2	131	3.7	e
5 Spotchem/Ready	41	97.6	2.4	0.0	148	7.2	e
6 Spotchem D-Concept	253	99.2	0.8	0.0	145	6.6	e
7 Architect	5	100.0	0.0	0.0	153	8.5	e*
8 Piccolo	45	100.0	0.0	0.0	111	2.2	e
9 Abx Mira	4	100.0	0.0	0.0	141	7.4	e*
10 Hitachi S40/M40	5	100.0	0.0	0.0	149	3.9	e
11 Autolyser/DiaSys	6	100.0	0.0	0.0	125	2.4	e

Amylase pancréatique

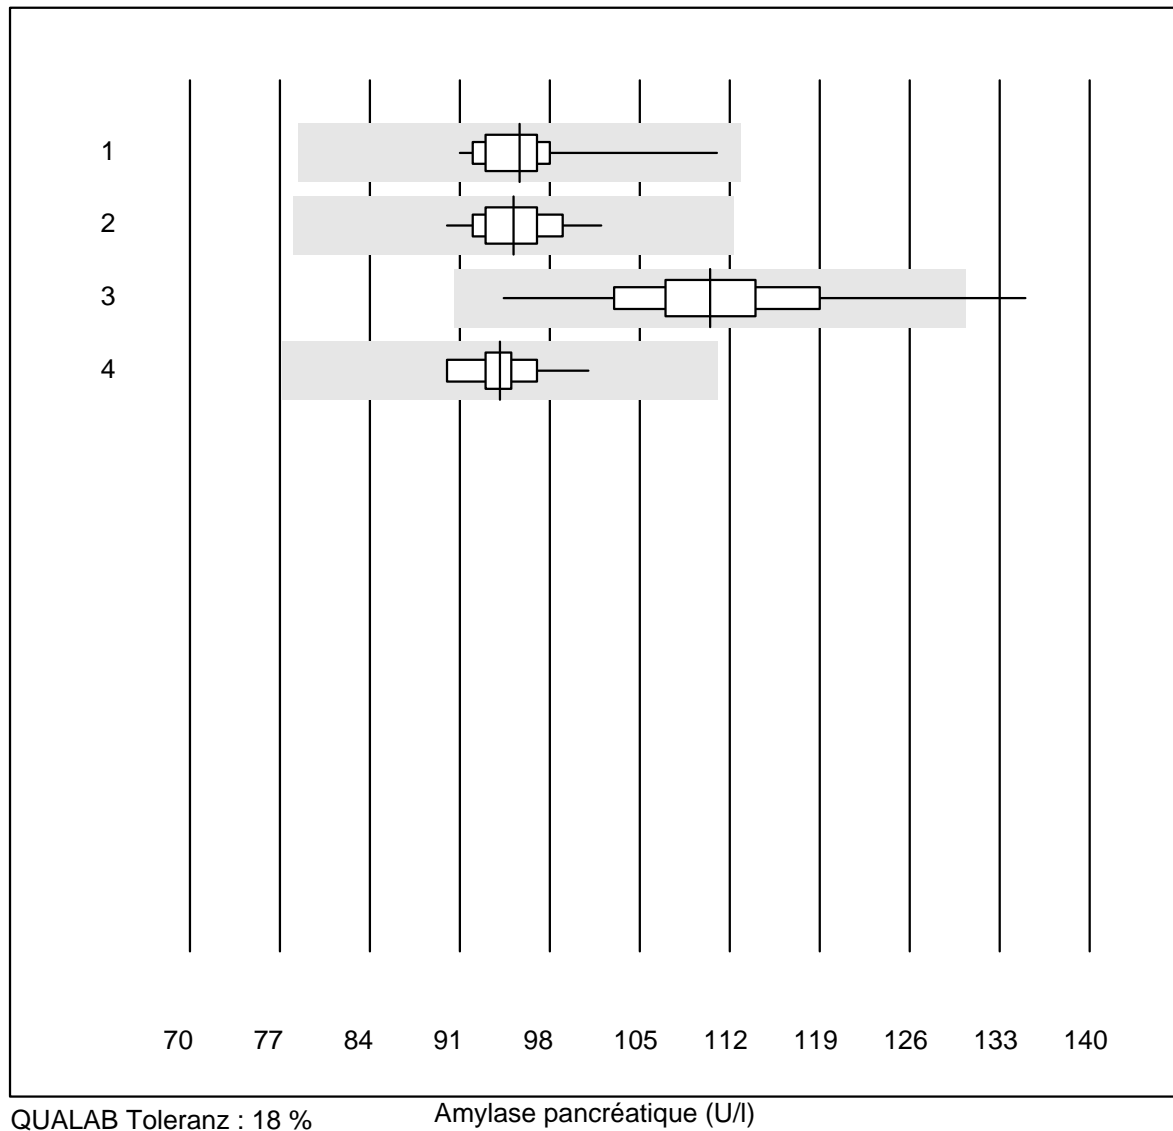

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	16	100.0	0.0	0.0	96	4.8	e
2 Cobas	13	100.0	0.0	0.0	95	3.5	e
3 Reflotron	306	97.4	1.0	1.6	110	5.6	e
4 Autolyser/DiaSys	10	100.0	0.0	0.0	94	3.3	e

Bilirubine totale

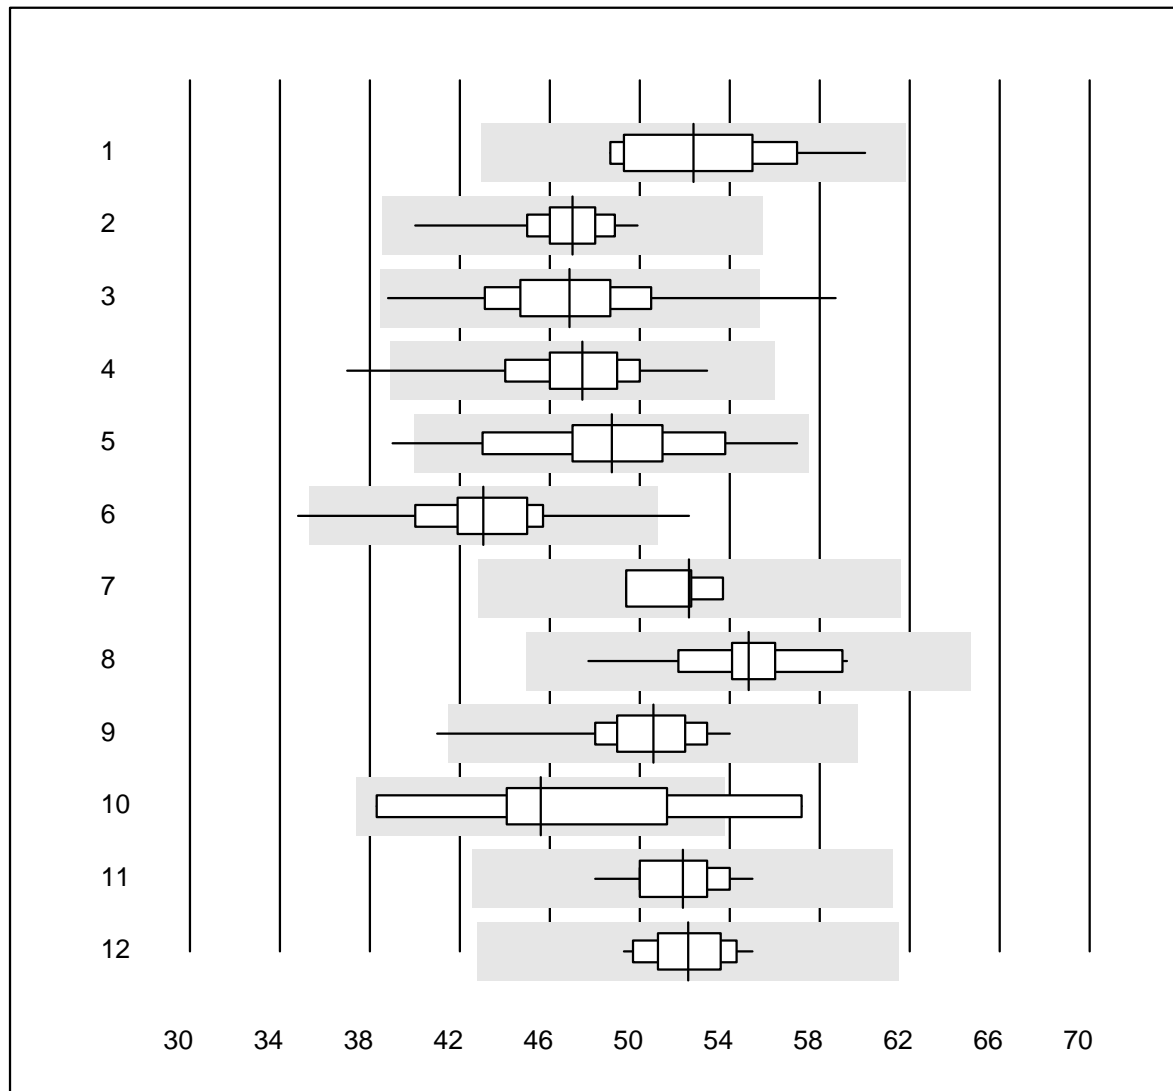


QUALAB Toleranz : 18 %

Bilirubine totale (µmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	13	100.0	0.0	0.0	52.4	6.8	e
2	Cobas	20	100.0	0.0	0.0	47.0	4.5	e
3	Reflotron	326	96.4	1.8	1.8	46.9	6.8	e
4	Fuji Dri-Chem	664	99.1	0.3	0.6	47.4	4.8	e
5	Spotchem/Ready	49	98.0	2.0	0.0	48.8	8.2	e
6	Spotchem D-Concept	253	98.0	1.2	0.8	43.1	5.3	e
7	Dimension	4	100.0	0.0	0.0	52.2	3.5	e
8	Beckman	11	100.0	0.0	0.0	54.8	5.8	e
9	Piccolo	52	94.3	1.9	3.8	50.6	4.9	e
10	Abx Mira	9	88.9	11.1	0.0	45.6	11.8	e*
11	Hitachi S40/M40	12	100.0	0.0	0.0	51.9	4.0	e
12	Autolyser/DiaSys	15	100.0	0.0	0.0	52.1	3.4	e

Bilirubine directe

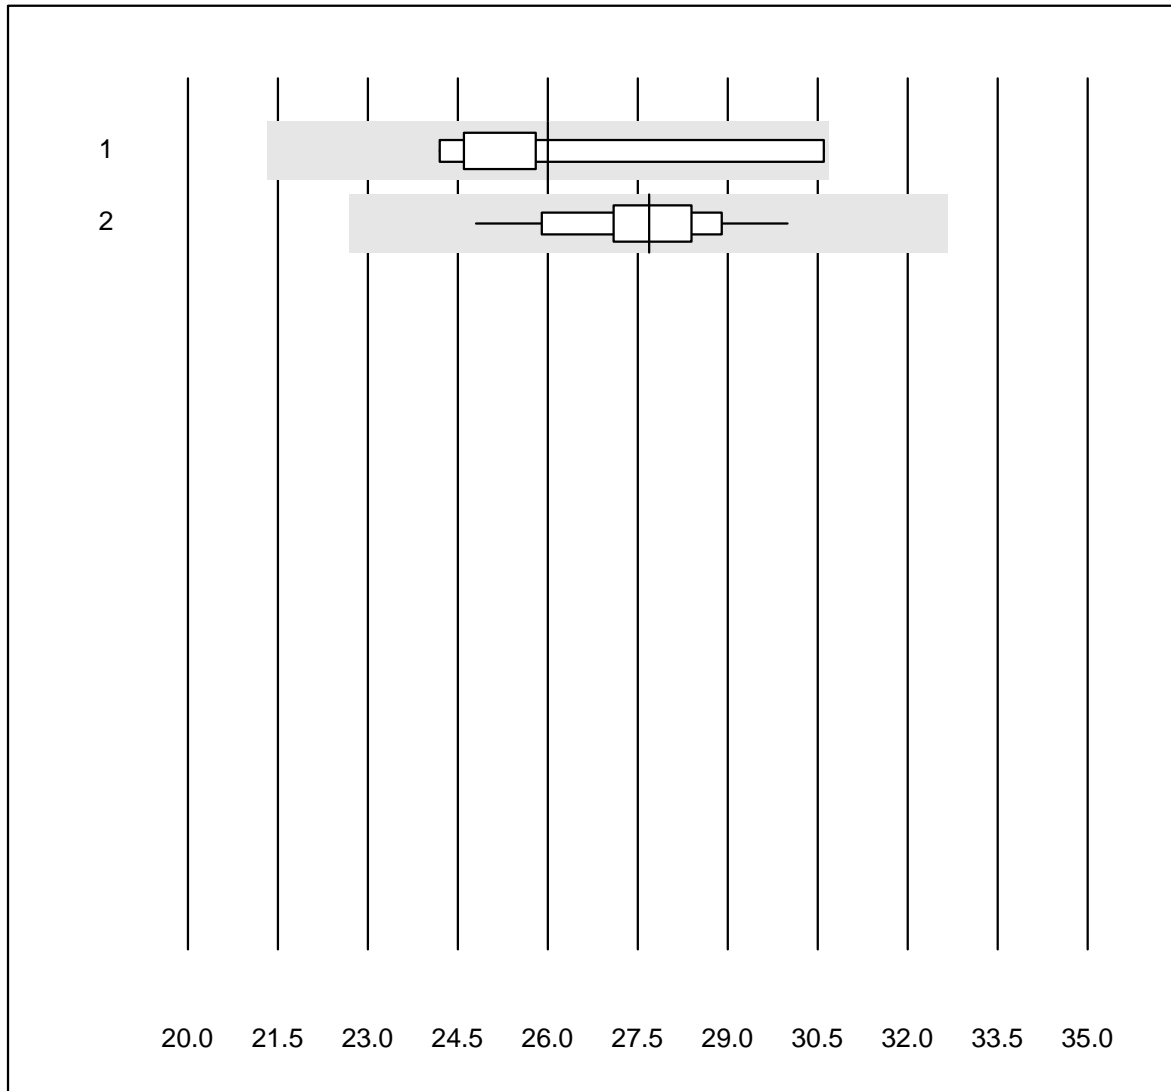


Tolérance MQ : 18 %

Bilirubine directe (µmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Autolyser/DiaSys	6	100.0	0.0	0.0	26.0	9.1	a
2	Fuji Dri-Chem	29	96.6	0.0	3.4	27.7	4.2	e

Calcium

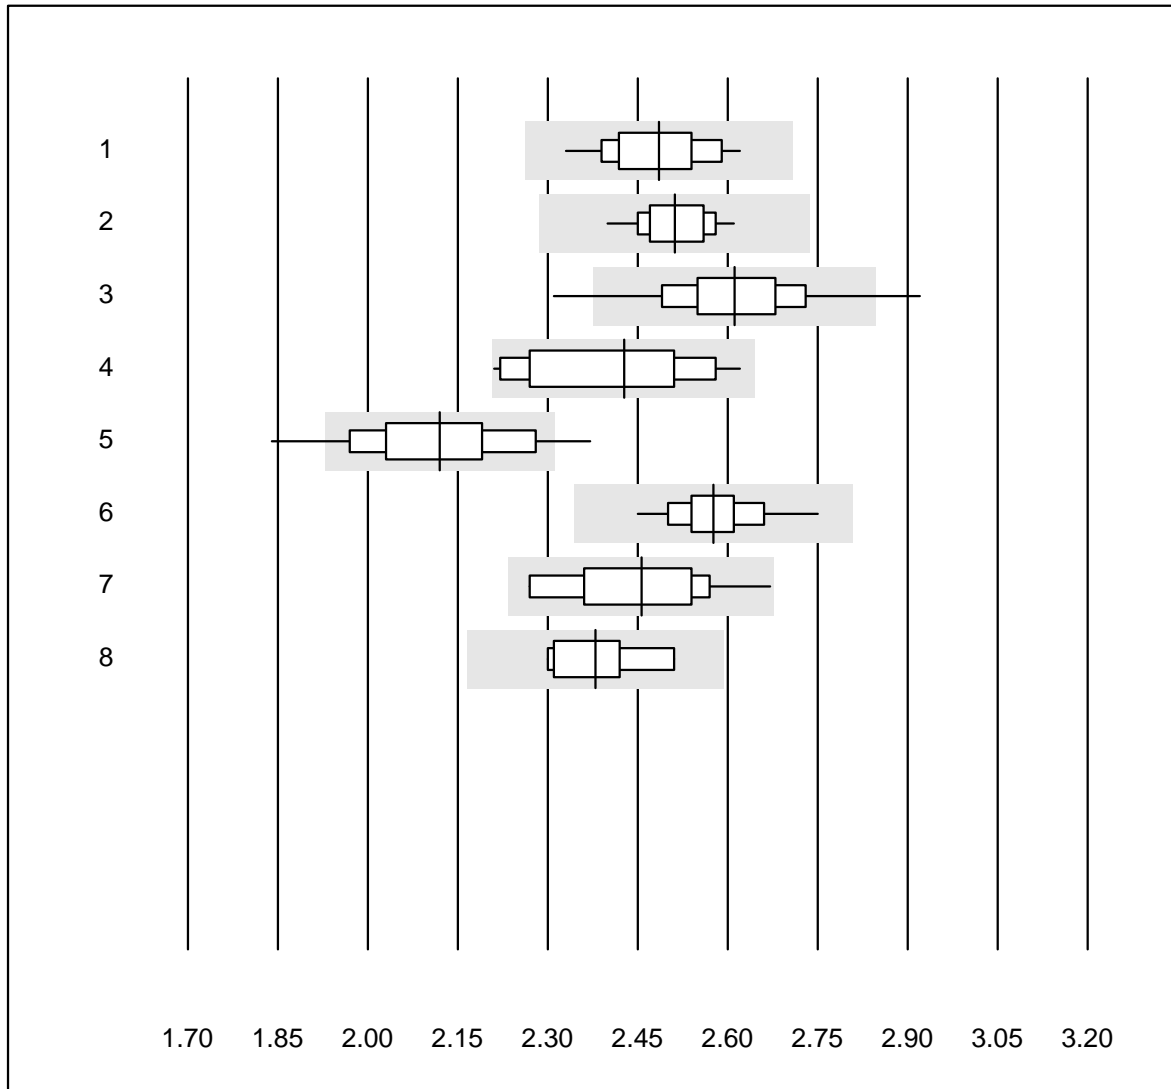


QUALAB Toleranz : 9 %

Calcium (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	28	100.0	0.0	0.0	2.49	3.1	e
2	Cobas	22	100.0	0.0	0.0	2.51	2.2	e
3	Fuji Dri-Chem	344	96.8	3.2	0.0	2.61	3.9	e
4	Spotchem/Ready	13	92.3	0.0	7.7	2.43	5.5	e*
5	Spotchem D-Concept	87	82.8	8.0	9.2	2.12	5.4	e
6	Piccolo	48	100.0	0.0	0.0	2.58	2.3	e
7	Hitachi S40/M40	10	100.0	0.0	0.0	2.46	5.2	e*
8	Autolyser/DiaSys	8	100.0	0.0	0.0	2.38	3.4	e*

Calcium ISE

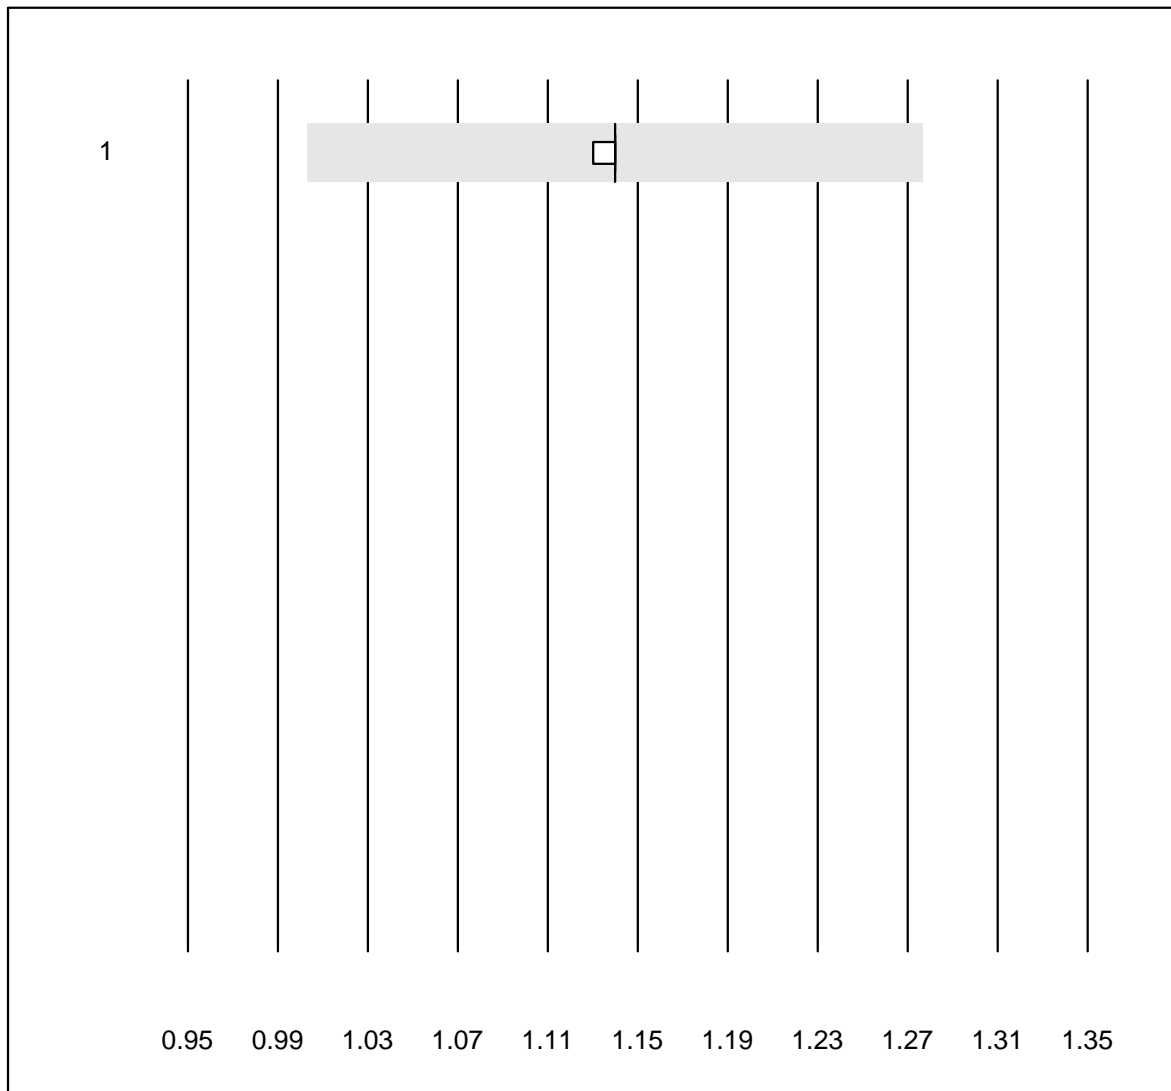


Tolérance MQ : 12 %

Calcium ISE (mmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	iStat Chem8	5	100.0	0.0	0.0	1.14	0.4	e

Chlorures

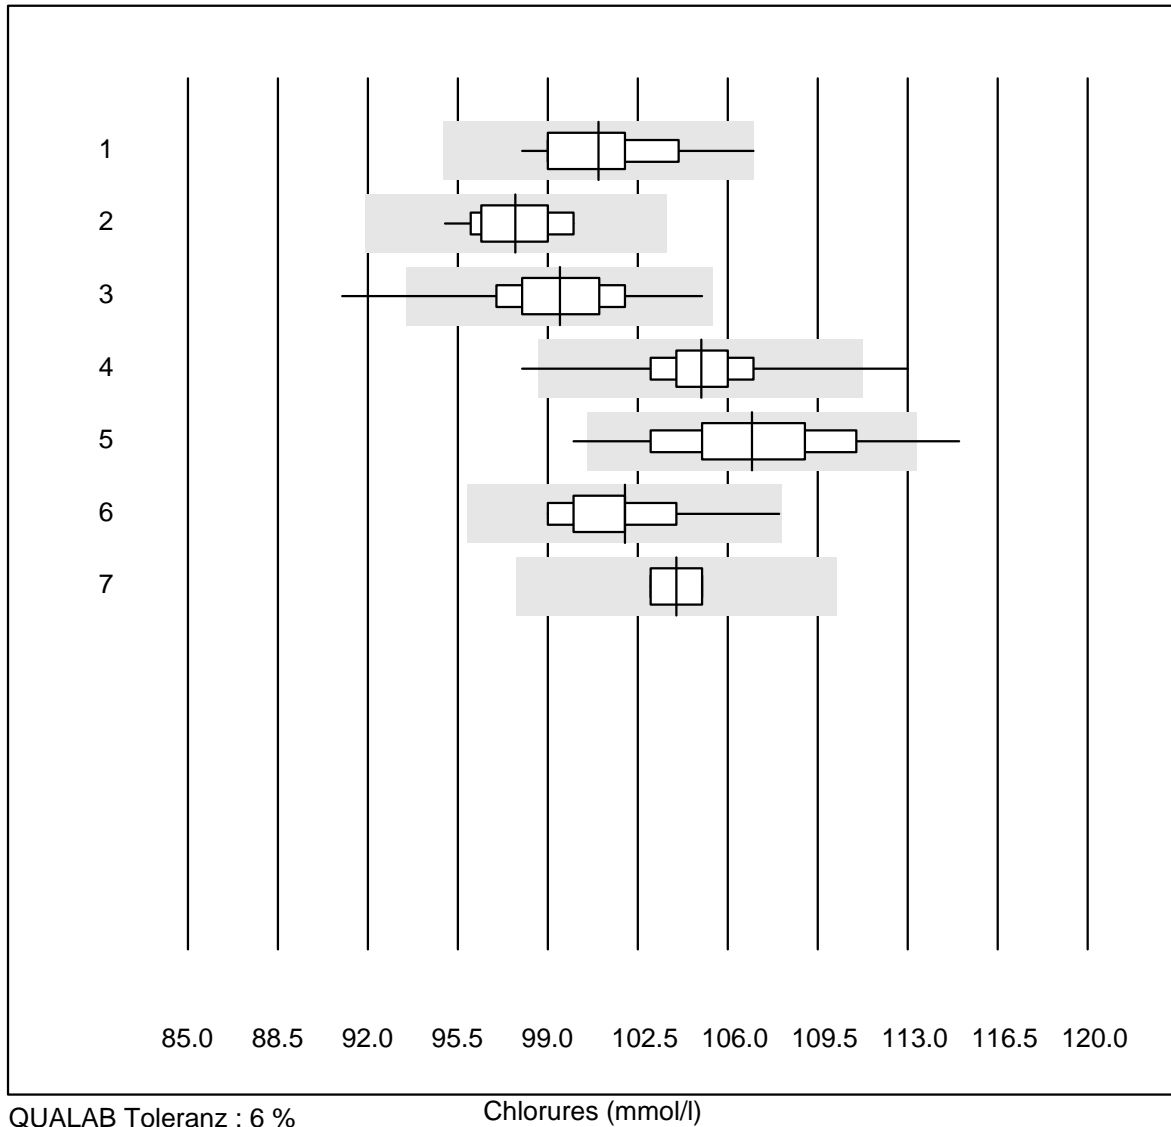

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 ISE	28	100.0	0.0	0.0	101	2.1	e
2 Cobas	13	100.0	0.0	0.0	98	1.6	e
3 Fuji Dri-Chem	756	97.3	1.9	0.8	99	2.1	e
4 Spotchem D-Concept	292	97.9	1.4	0.7	105	1.9	e
5 Spotchem EL-SE 1520	61	91.8	4.9	3.3	107	2.9	e
6 Piccolo	24	100.0	0.0	0.0	102	2.0	e
7 iStat Chem8	5	100.0	0.0	0.0	104	1.0	e

Cholestérol

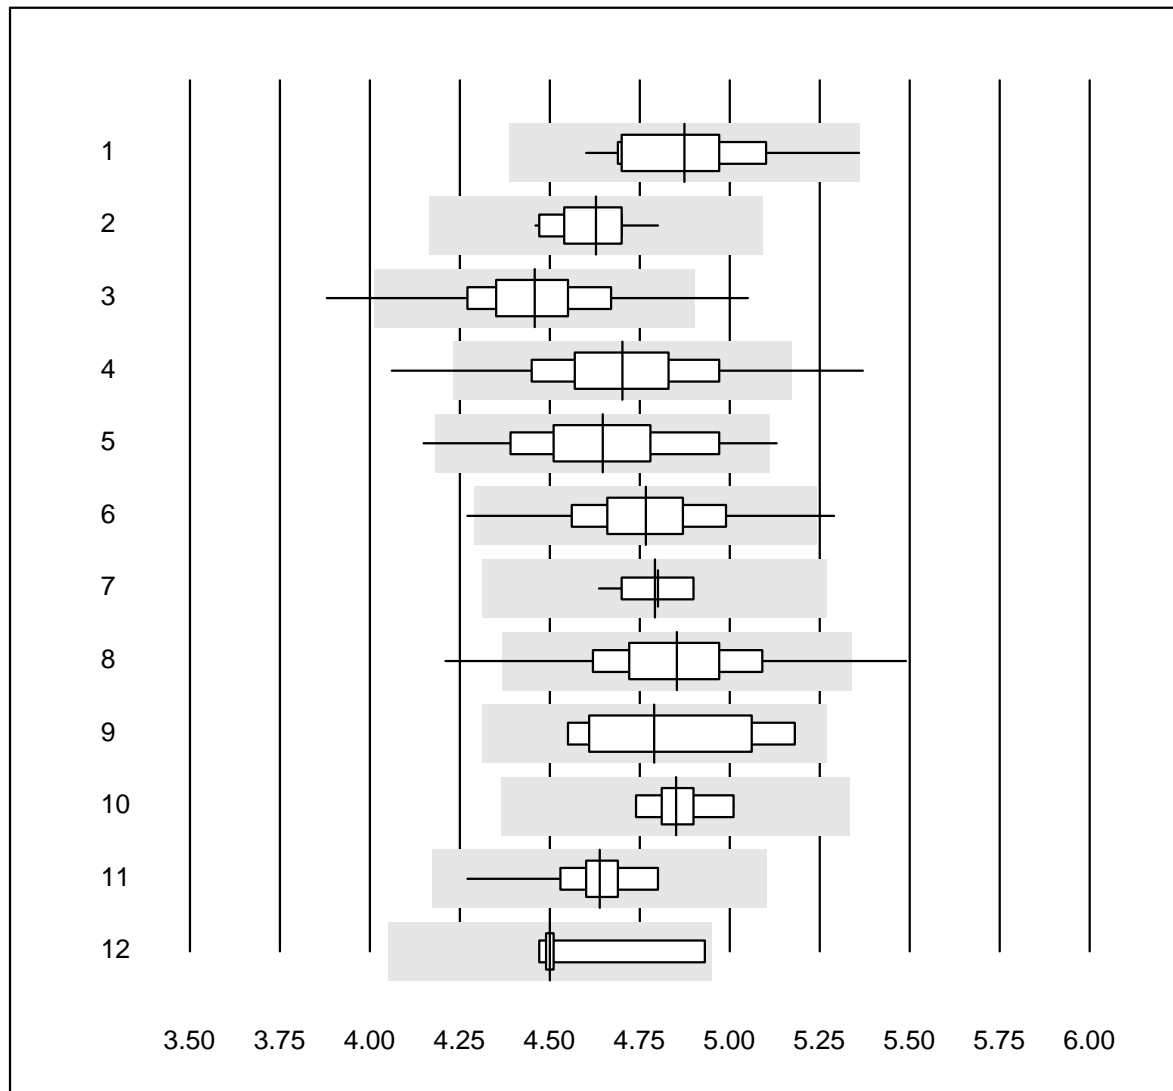


QUALAB Toleranz : 10 %

Cholestérol (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	27	92.6	0.0	7.4	4.87	3.8	e
2	Cobas	20	100.0	0.0	0.0	4.63	2.1	e
3	Reflotron	350	97.7	2.0	0.3	4.46	3.7	e
4	Fuji Dri-Chem	806	96.8	2.1	1.1	4.70	4.4	e
5	Spotchem/Ready	71	95.8	4.2	0.0	4.65	4.6	e
6	Spotchem D-Concept	320	98.8	0.9	0.3	4.77	3.6	e
7	Piccolo	20	100.0	0.0	0.0	4.79	1.4	e
8	Cholestech LDX	315	97.1	1.6	1.3	4.85	4.0	e
9	Abx Mira	7	100.0	0.0	0.0	4.79	5.0	e*
10	Hitachi S40/M40	9	100.0	0.0	0.0	4.85	1.8	e
11	Autolyser/DiaSys	18	94.4	0.0	5.6	4.64	2.7	e
12	Autres méthodes	5	100.0	0.0	0.0	4.50	4.3	e*

Cholestérol HDL

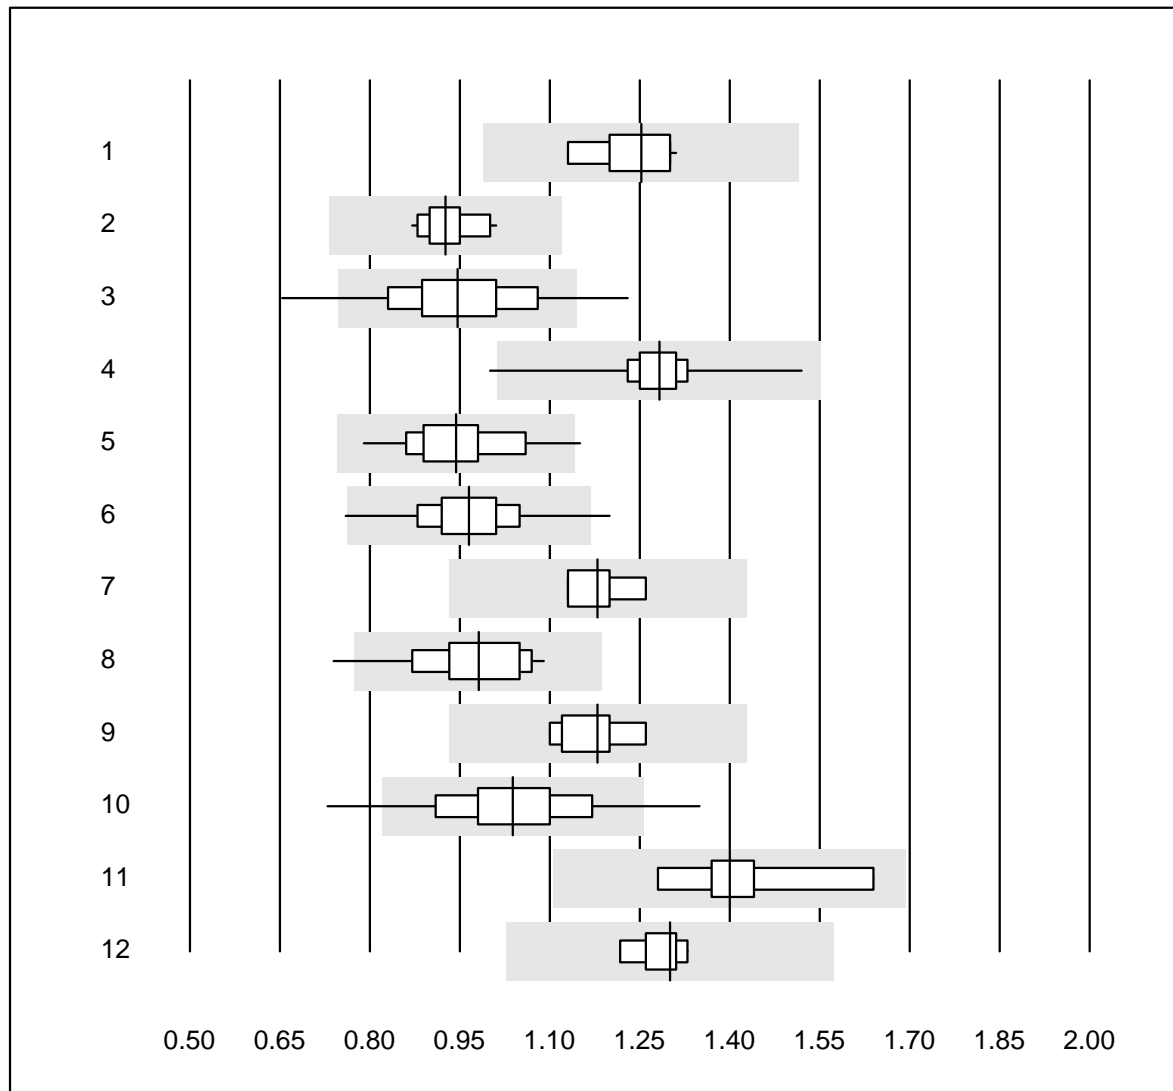


QUALAB Toleranz : 21 %

Cholestérol HDL (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	humide, direct	10	100.0	0.0	0.0	1.25	4.8	e
2	Cobas	18	100.0	0.0	0.0	0.93	4.4	e
3	Reflotron	253	90.2	4.3	5.5	0.95	10.1	e
4	Fuji Dri-Chem	782	99.1	0.3	0.6	1.28	3.4	e
5	Spotchem/Ready	66	98.5	1.5	0.0	0.94	7.8	e
6	Spotchem D-Concept	311	98.8	0.6	0.6	0.97	7.1	e
7	Dimension	4	100.0	0.0	0.0	1.18	4.7	e
8	Piccolo	18	83.3	5.6	11.1	0.98	9.1	e
9	Pentra/Selectra	9	100.0	0.0	0.0	1.18	4.8	e
10	Cholestech LDX	316	93.7	3.5	2.8	1.04	9.7	e
11	Hitachi S40/M40	9	100.0	0.0	0.0	1.40	7.2	e
12	Architect	7	100.0	0.0	0.0	1.30	2.9	e
13	Autolyser/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	1.20	4.4	e

Créatine-kinase

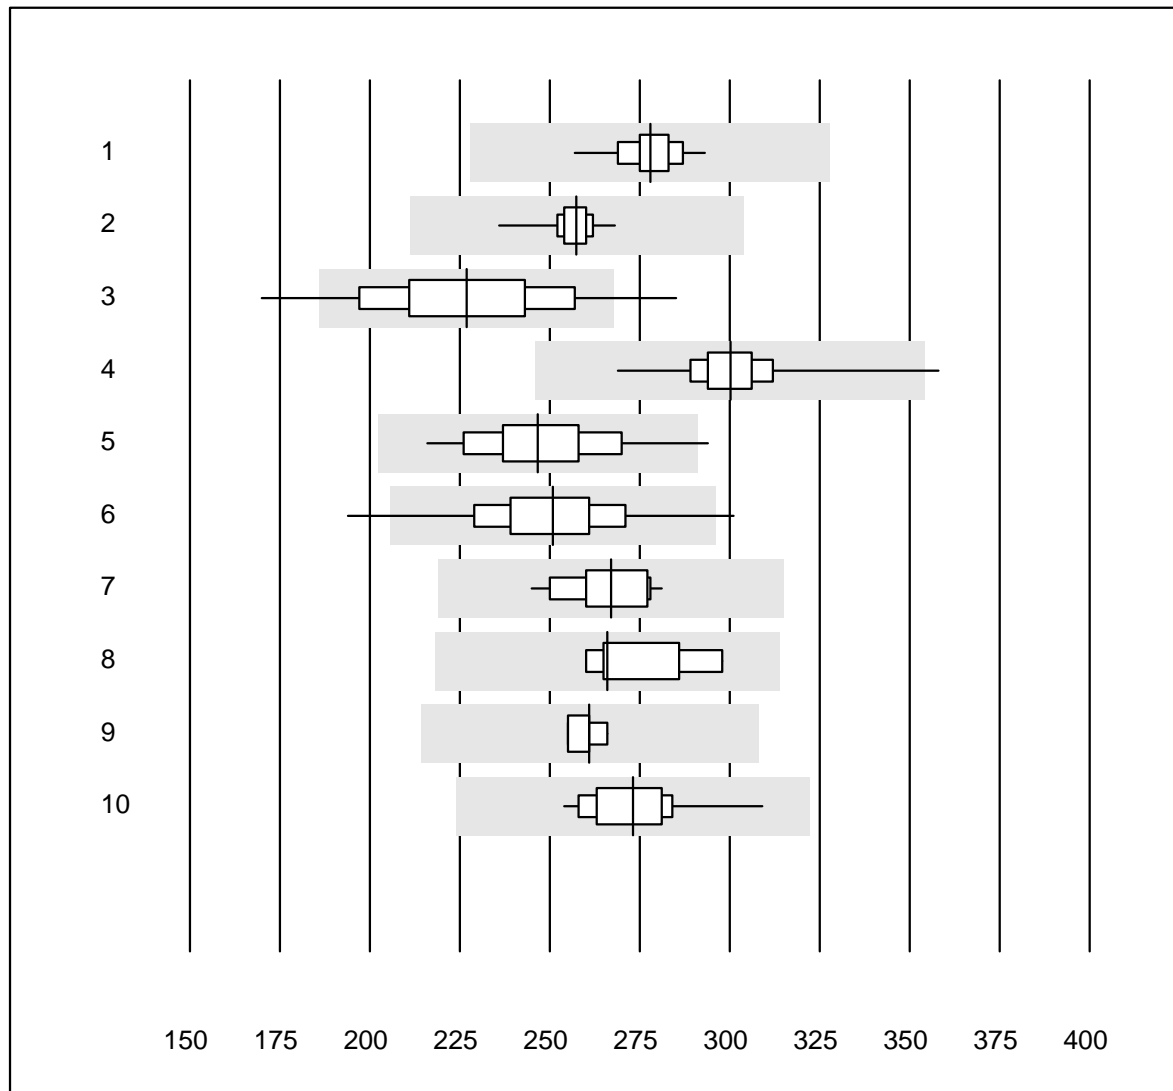


QUALAB Toleranz : 18 %

Créatine-kinase (U/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	22	100.0	0.0	0.0	278	2.7	e
2 Cobas	20	100.0	0.0	0.0	257	2.5	e
3 Reflotron	296	86.8	8.1	5.1	227	10.4	e
4 Fuji Dri-Chem	552	98.5	0.2	1.3	300	3.3	e
5 Spotchem/Ready	33	97.0	3.0	0.0	247	7.1	e
6 Spotchem D-Concept	196	97.5	1.5	1.0	251	6.6	e
7 Piccolo	19	100.0	0.0	0.0	267	3.9	e
8 Abx Mira	5	100.0	0.0	0.0	266	5.9	e*
9 Dimension	4	100.0	0.0	0.0	261	1.7	e
10 Autolyser/DiaSys	15	100.0	0.0	0.0	273	5.0	e

Cholésterol LDL

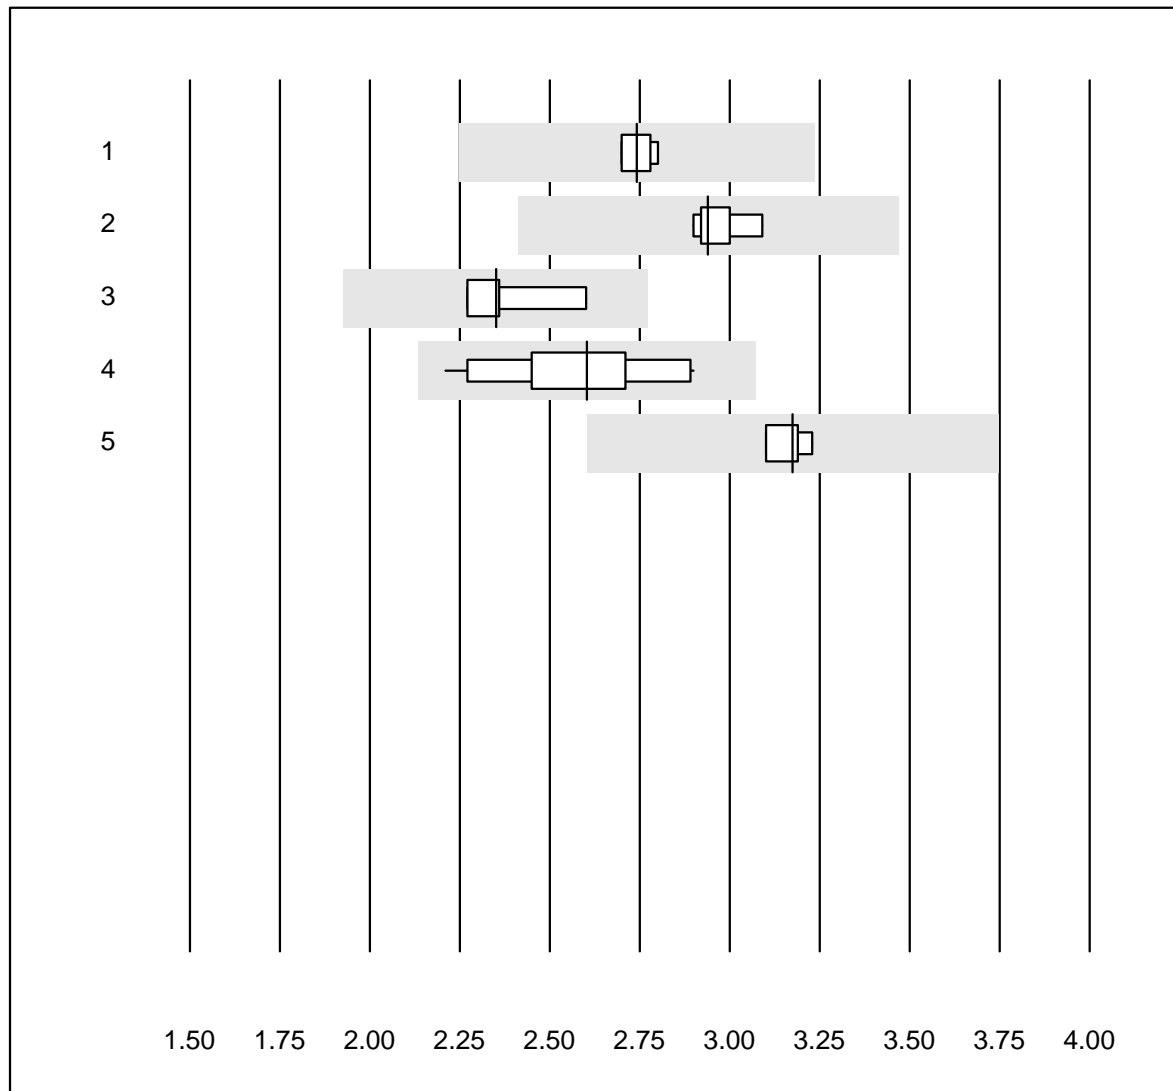


QUALAB Toleranz : 18 %

Cholésterol LDL (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	10	100.0	0.0	0.0	2.7	1.5	e
2	Roche, Cobas	9	100.0	0.0	0.0	2.9	2.1	e
3	Hitachi S40/M40	4	100.0	0.0	0.0	2.4	6.0	e*
4	Autolyser/DiaSys	13	100.0	0.0	0.0	2.6	8.1	e*
5	Beckman	8	100.0	0.0	0.0	3.2	1.6	e

Fer

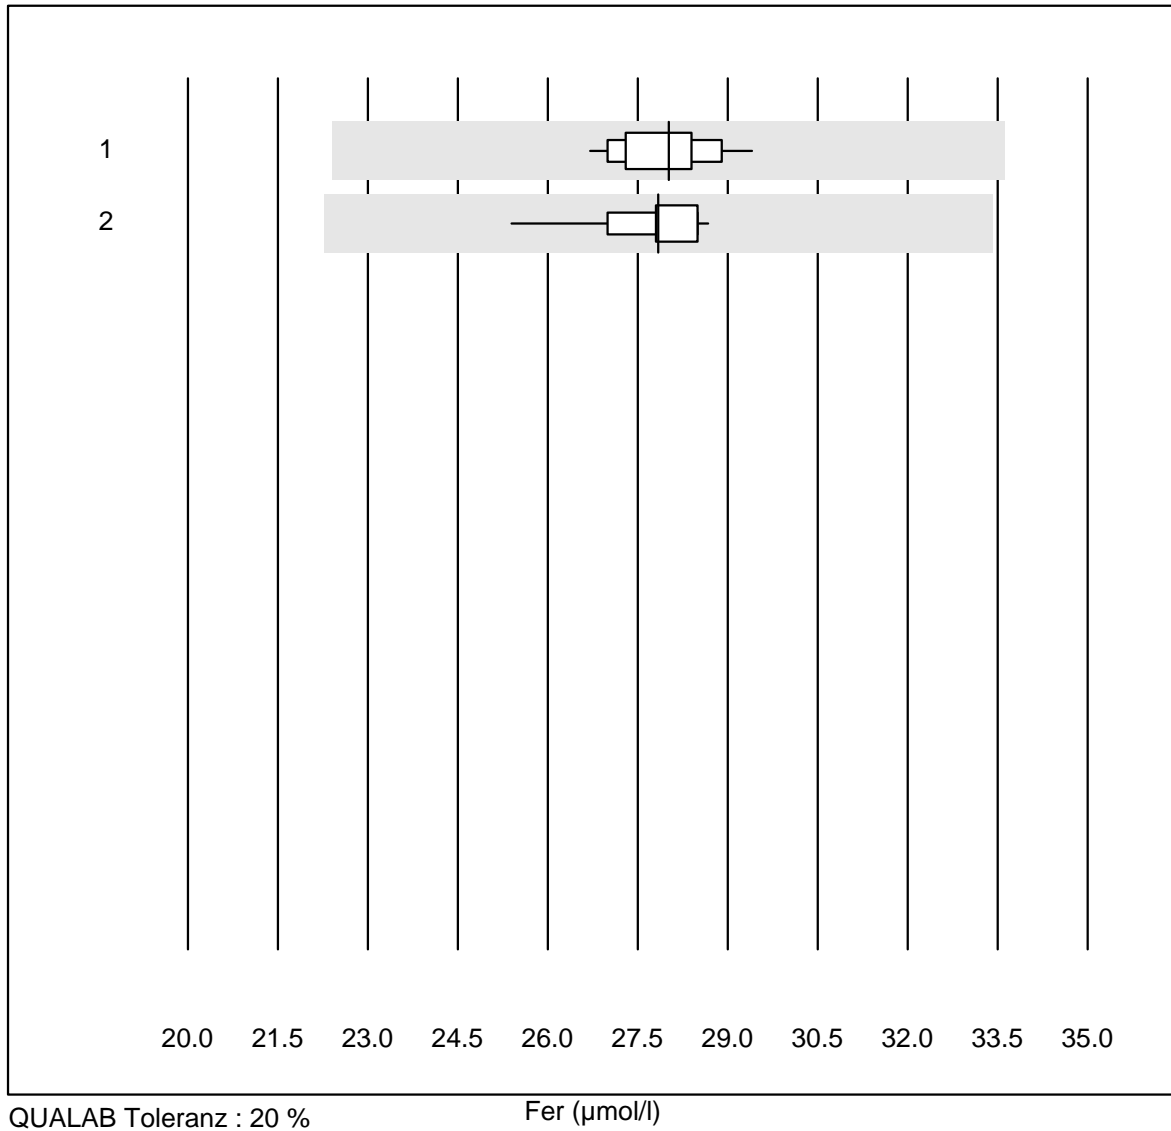


QUALAB Toleranz : 20 %

Fer ($\mu\text{mol/l}$)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	16	100.0	0.0	0.0	28	2.6	e
2	Cobas	11	100.0	0.0	0.0	28	3.3	e

Gamma-GT

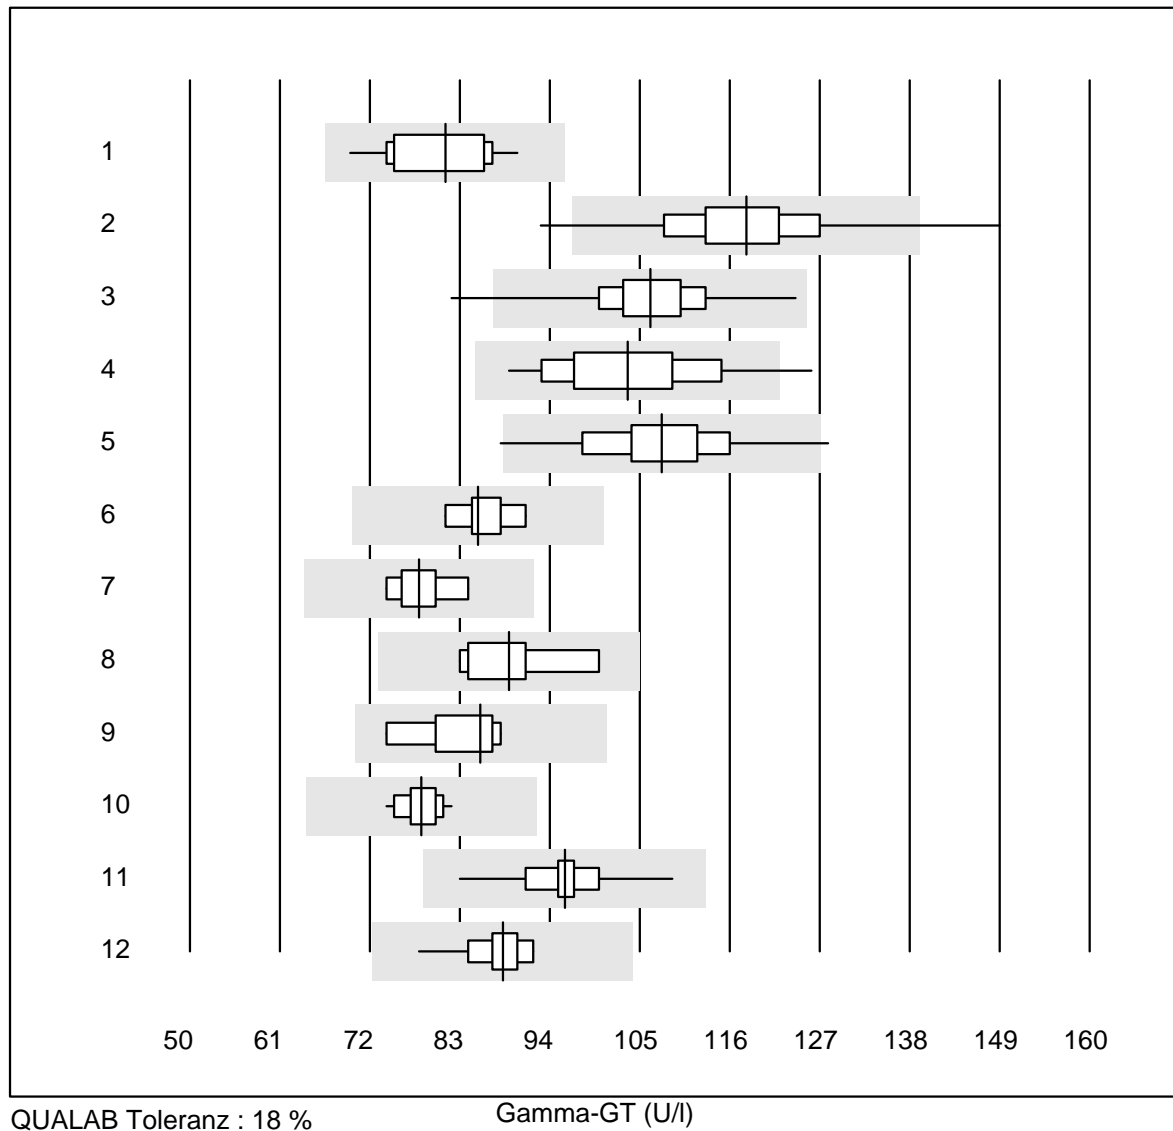


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	22	100.0	0.0	0.0	81	7.7	e
2 Reflotron	579	97.4	1.6	1.0	118	6.6	e
3 Fuji Dri-Chem	903	99.4	0.2	0.4	106	5.1	e
4 Spotchem/Ready	78	97.4	2.6	0.0	103	8.2	e
5 Spotchem D-Concept	361	98.6	0.6	0.8	108	6.3	e
6 Selectra/Biolis	6	100.0	0.0	0.0	85	3.9	e
7 Architect	8	100.0	0.0	0.0	78	4.2	e
8 Dimension	8	100.0	0.0	0.0	89	6.2	e*
9 IFCC Beckmann	8	100.0	0.0	0.0	86	5.8	e
10 Piccolo	42	100.0	0.0	0.0	78	2.9	e
11 Hitachi S40/M40	14	100.0	0.0	0.0	96	5.7	e
12 Autolyser/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	88	3.7	e

Glucose

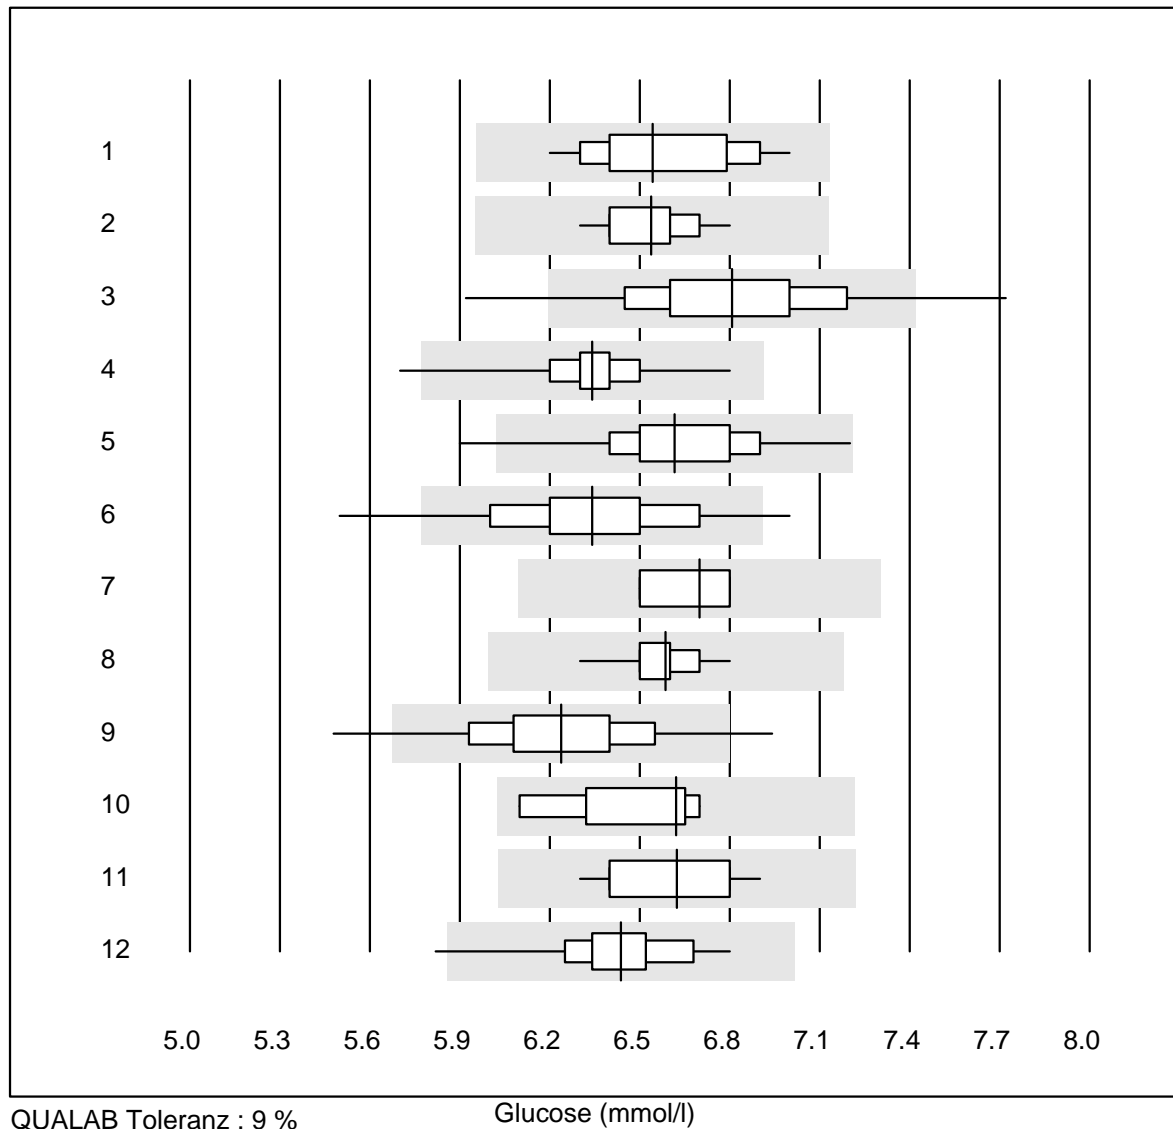


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	28	96.4	0.0	3.6	6.5	3.4	e
2	Cobas	21	100.0	0.0	0.0	6.5	2.0	e
3	Reflotron	571	93.3	4.2	2.5	6.8	4.4	e
4	Fuji Dri-Chem	851	99.4	0.1	0.5	6.3	2.3	e
5	Spotchem/Ready	70	92.9	1.4	5.7	6.6	3.8	e
6	Spotchem D-Concept	337	97.9	1.8	0.3	6.3	3.8	e
7	Dimension	4	100.0	0.0	0.0	6.7	2.2	e*
8	Piccolo	55	100.0	0.0	0.0	6.6	1.5	e
9	Cholestech LDX	304	98.0	2.0	0.0	6.2	3.9	e
10	Abx Mira	7	100.0	0.0	0.0	6.6	3.5	e*
11	Hitachi S40/M40	16	100.0	0.0	0.0	6.6	2.7	e
12	Autolyser/DiaSys	18	94.4	5.6	0.0	6.4	3.2	e
13	iStat Chem8	7	100.0	0.0	0.0	5.9	0.8	e

Glucose

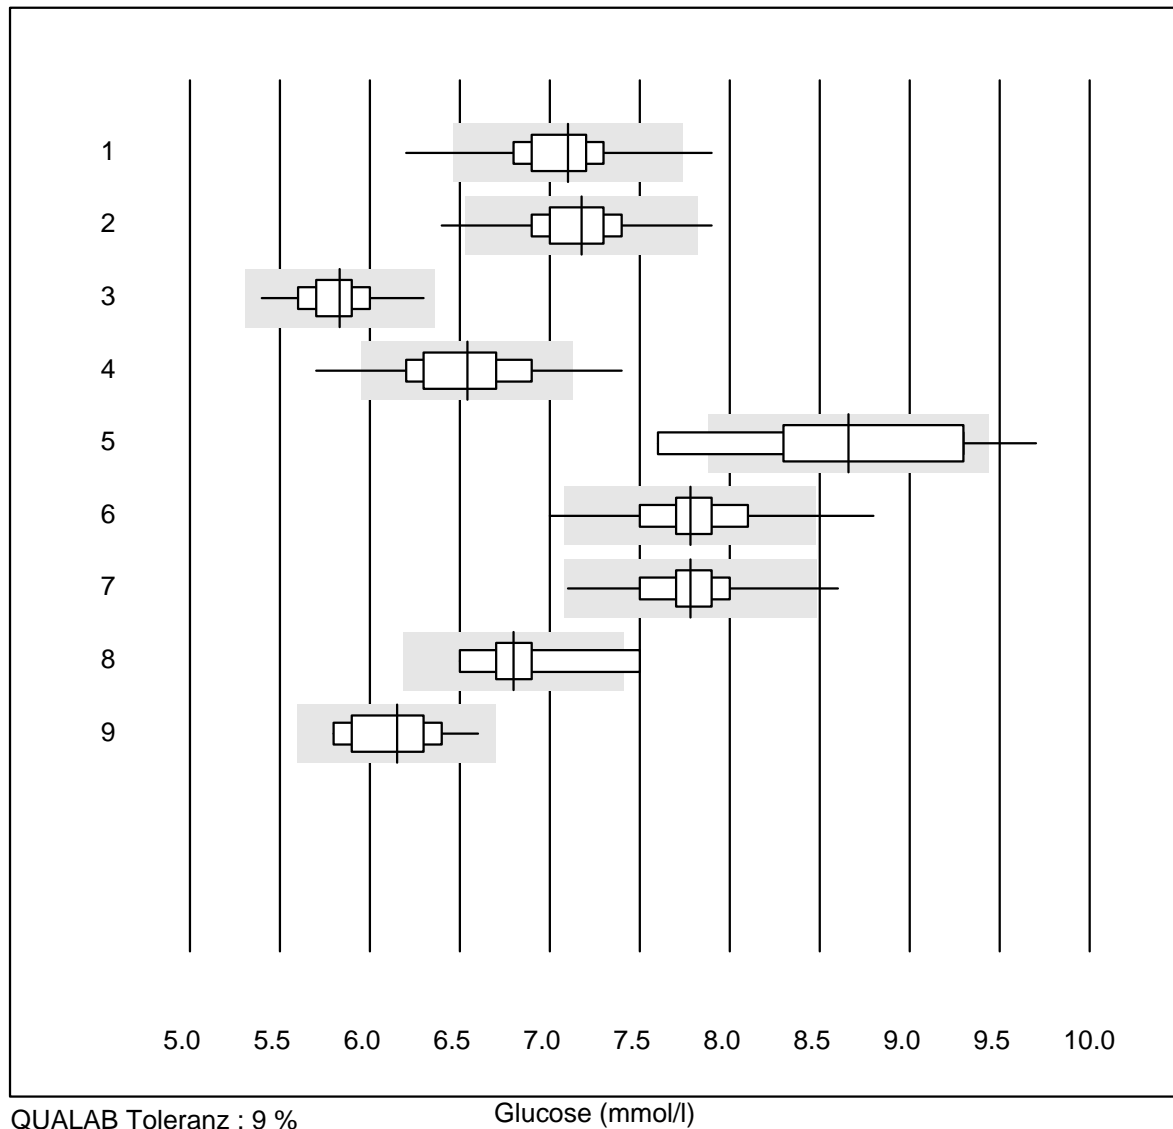


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Accu-Chek Aviva	371	95.4	2.7	1.9	7.1	3.1	e
2	Accu-Chek Inform 2	729	99.3	0.4	0.3	7.2	2.9	e
3	Accu-Check Guide	210	99.0	0.0	1.0	5.8	3.1	e
4	Contour XT	1263	95.7	3.3	1.0	6.5	4.2	e
5	Glucocard	11	72.7	18.2	9.1	8.7	7.3	e*
6	Hemocue 201+ P-equiv	99	97.0	2.0	1.0	7.8	3.2	e
7	Hemocue 201RT P-equiv	118	96.7	0.8	2.5	7.8	2.8	e
8	Freestyle Freedom li	5	80.0	20.0	0.0	6.8	5.5	e*
9	Contour NEXT	10	100.0	0.0	0.0	6.2	4.3	e*

Glucose

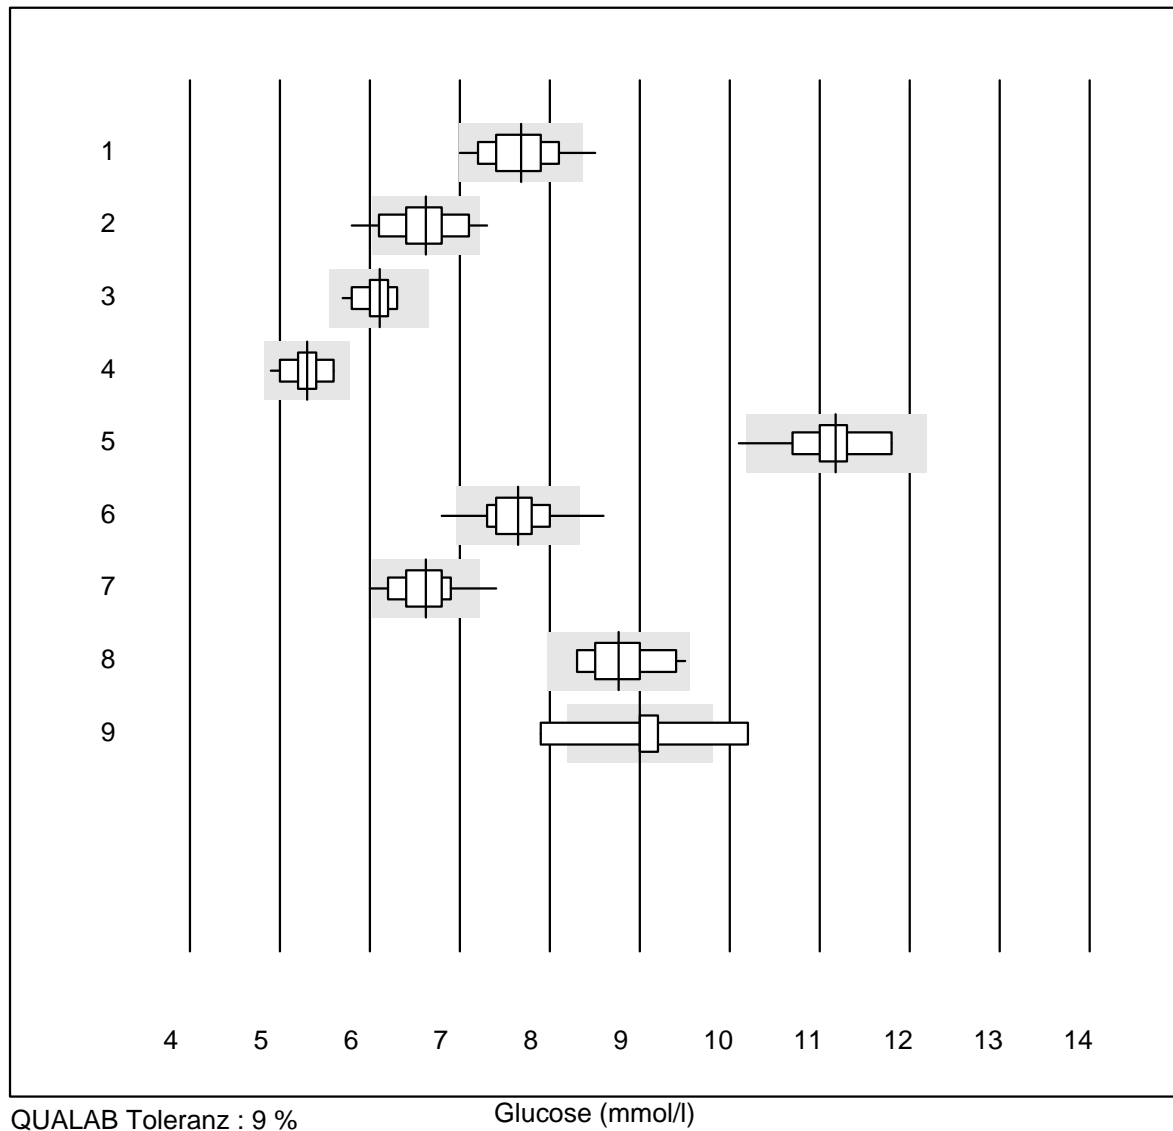


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Hemocue 201+ (alt)	42	95.2	2.4	2.4	7.7	4.5	e
2	AccuChek Sensor	29	86.3	10.3	3.4	6.6	5.5	e
3	OneTouch Verio	26	100.0	0.0	0.0	6.1	2.8	e
4	Contour 2 (5s)	18	100.0	0.0	0.0	5.3	3.8	e
5	Healthpro	29	96.6	3.4	0.0	11.2	3.5	e
6	Mylife UNIO	283	98.6	1.4	0.0	7.6	3.6	e
7	mylife Pura	77	93.5	6.5	0.0	6.6	4.4	e
8	Omnitest	15	93.3	0.0	6.7	8.8	4.6	e*
9	Alpha Check	7	42.8	28.6	28.6	9.0	9.0	e*

Acide urique

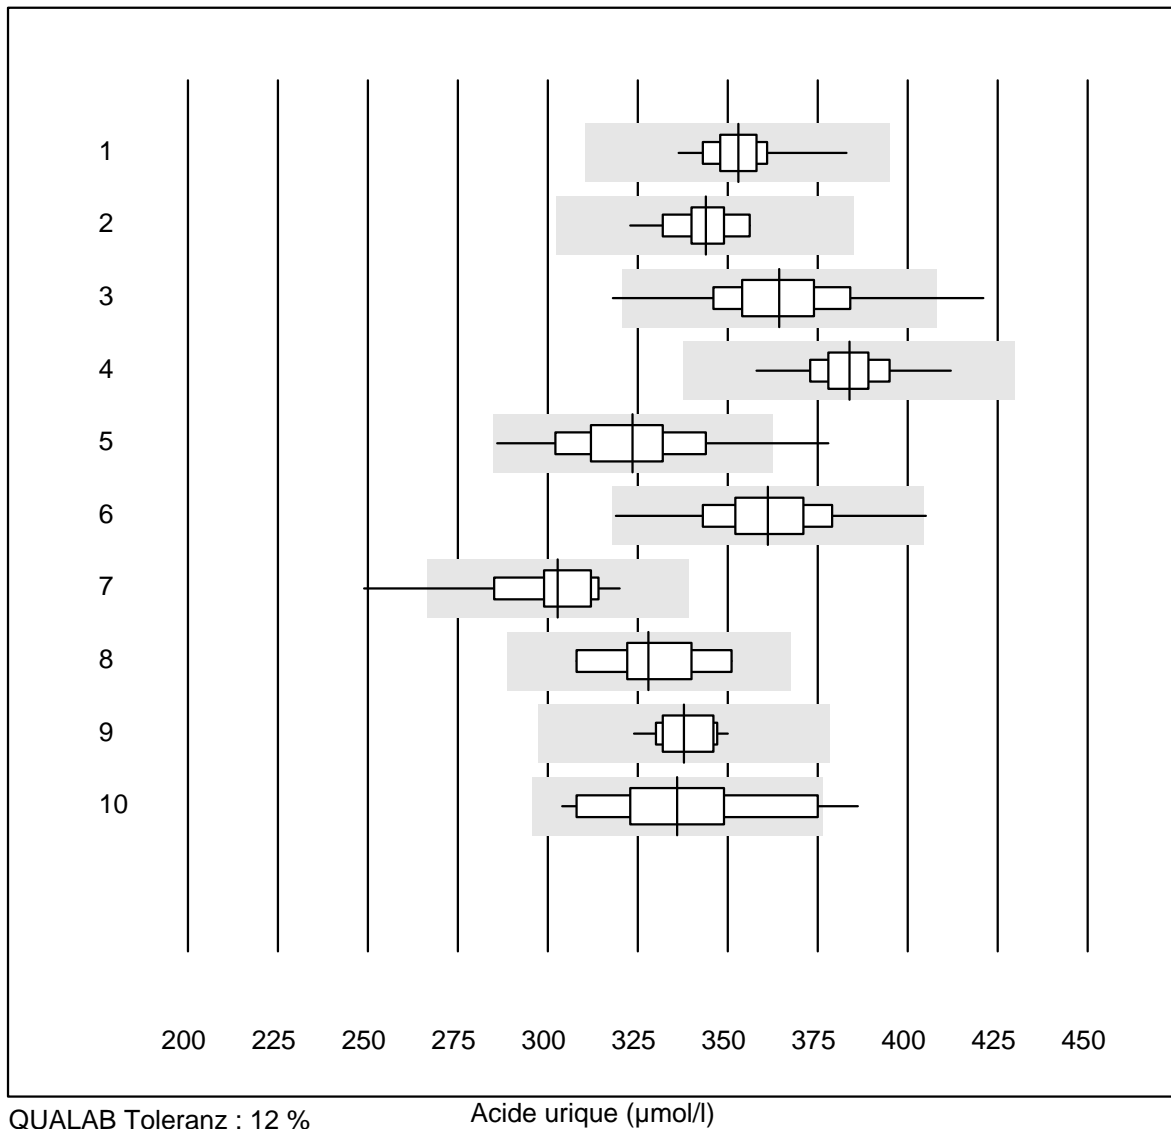


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	30	100.0	0.0	0.0	353	2.5	e
2	Cobas	19	100.0	0.0	0.0	344	2.3	e
3	Reflotron	503	98.4	0.8	0.8	364	4.1	e
4	Fuji Dri-Chem	841	99.4	0.0	0.6	384	2.3	e
5	Spotchem/Ready	62	96.8	1.6	1.6	324	5.4	e
6	Spotchem D-Concept	335	99.1	0.6	0.3	361	4.1	e
7	Piccolo	27	96.3	3.7	0.0	303	4.6	e
8	Abx Mira	7	100.0	0.0	0.0	328	4.2	e*
9	Hitachi S40/M40	14	100.0	0.0	0.0	338	2.3	e
10	Autolyser/DiaSys	17	94.1	5.9	0.0	336	6.6	e*

Urée

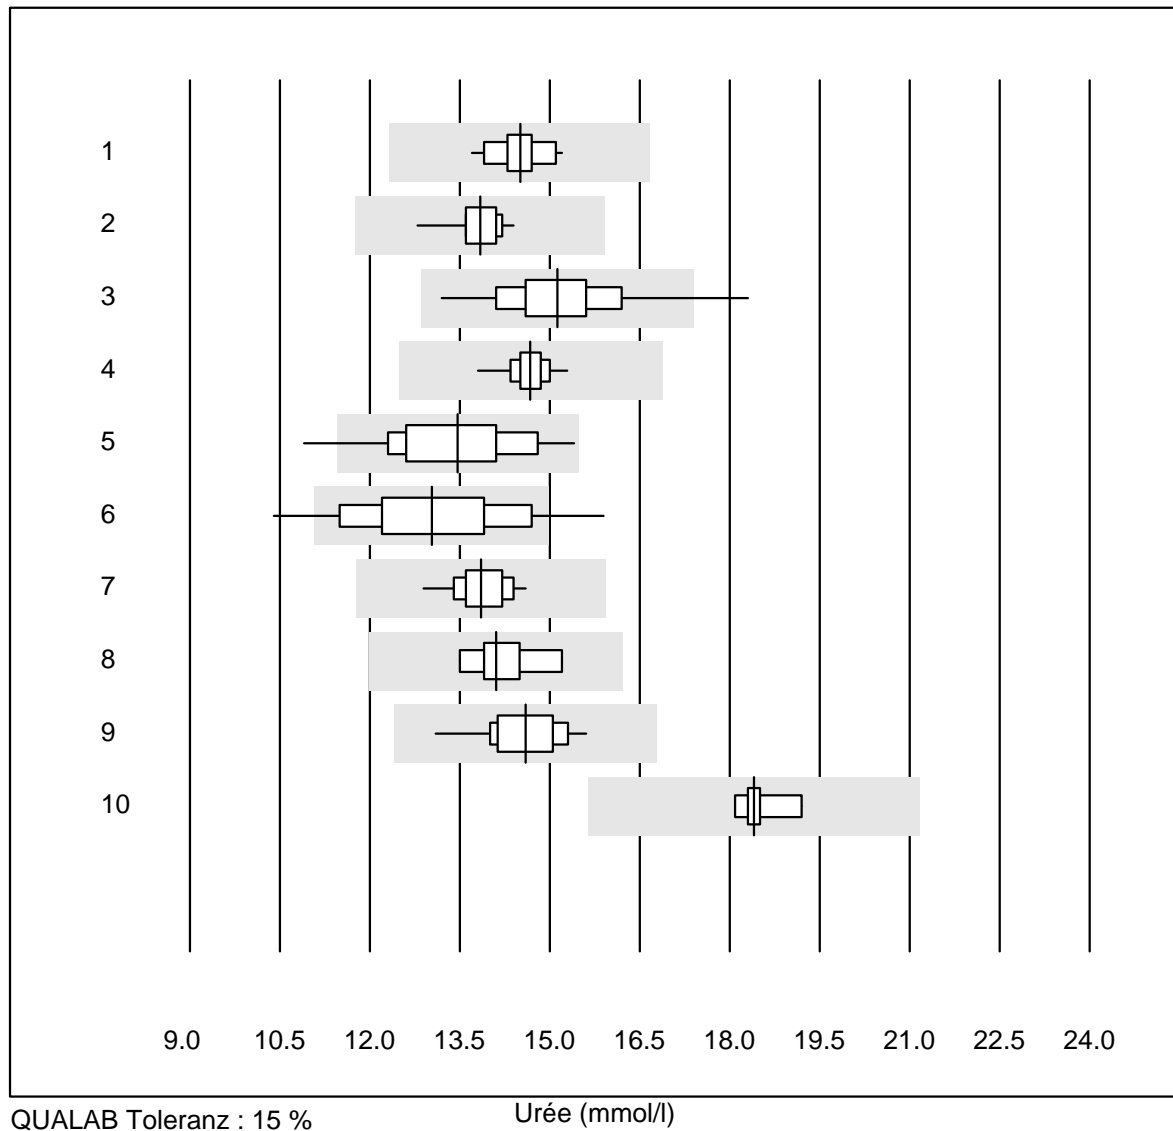

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	27	100.0	0.0	0.0	14.5	2.6	e
2	Cobas	21	100.0	0.0	0.0	13.8	2.7	e
3	Reflotron	231	97.9	1.7	0.4	15.1	5.6	e
4	Fuji Dri-Chem	505	99.4	0.0	0.6	14.7	1.7	e
5	Spotchem/Ready	44	95.4	2.3	2.3	13.5	7.4	e
6	Spotchem D-Concept	204	86.3	10.3	3.4	13.0	9.1	e
7	Piccolo	48	97.9	0.0	2.1	13.9	2.8	e
8	Hitachi S40/M40	9	100.0	0.0	0.0	14.1	3.7	e
9	Autolyser/DiaSys	14	100.0	0.0	0.0	14.6	4.4	e
10	iStat Chem8	6	100.0	0.0	0.0	18.4	2.0	e

Potassium

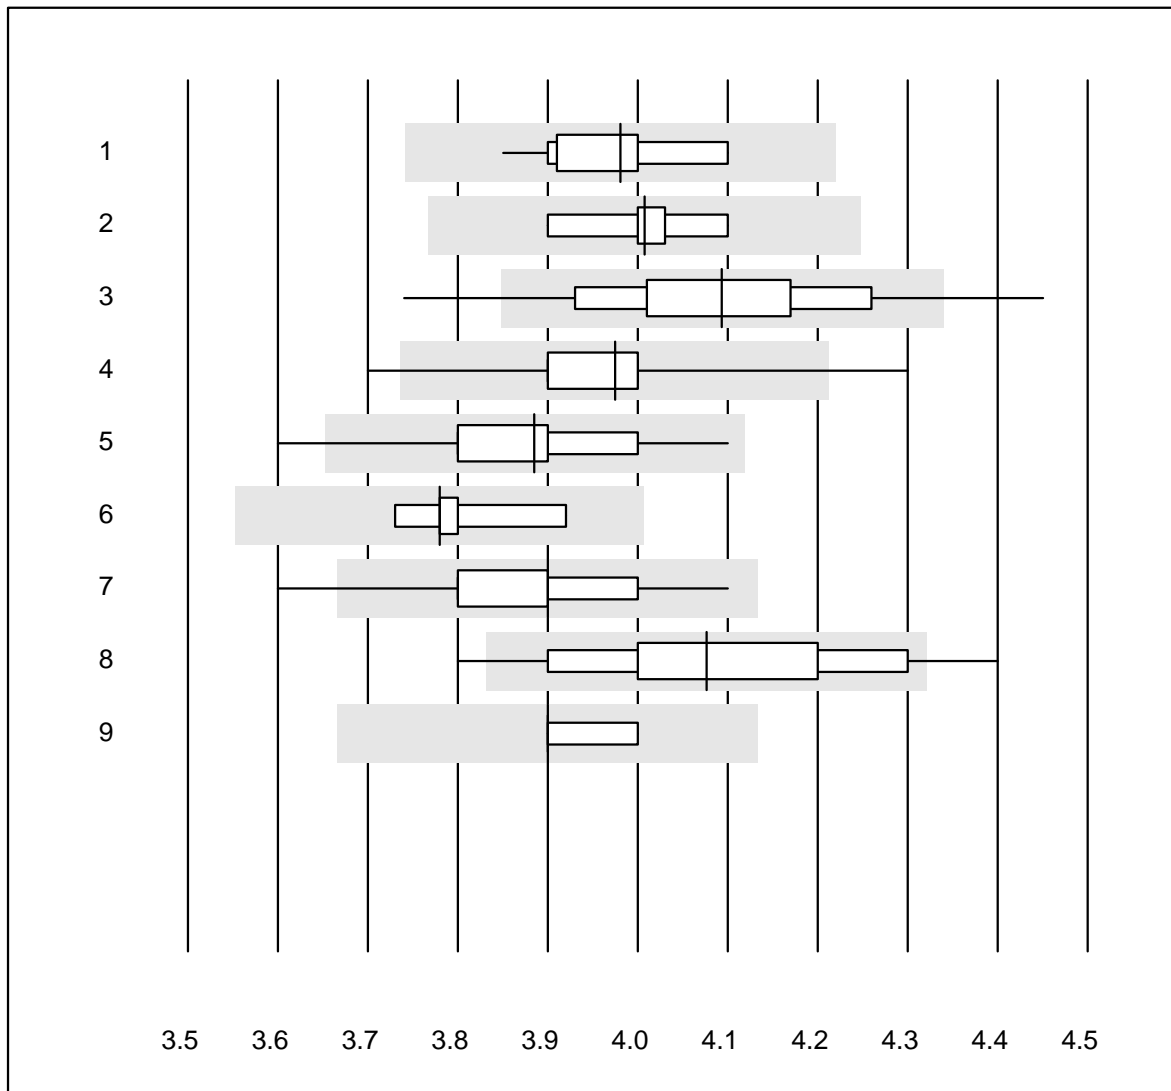


QUALAB Toleranz : 6 %

Potassium (mmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ISE	40	100.0	0.0	0.0	3.98	1.7	e
2	Cobas	21	100.0	0.0	0.0	4.01	1.5	e
3	Reflotron	519	90.2	6.9	2.9	4.09	3.1	e
4	Fuji Dri-Chem	888	97.4	1.5	1.1	3.97	1.9	e
5	Spotchem D-Concept	340	98.5	0.3	1.2	3.89	1.7	e
6	Autolyser/DiaSys	5	100.0	0.0	0.0	3.78	1.9	e*
7	Spotchem EL-SE 1520	68	95.6	2.9	1.5	3.90	2.3	e
8	Piccolo	39	79.5	7.7	12.8	4.08	3.8	e
9	iStat Chem8	8	100.0	0.0	0.0	3.90	1.2	e

Créatinine

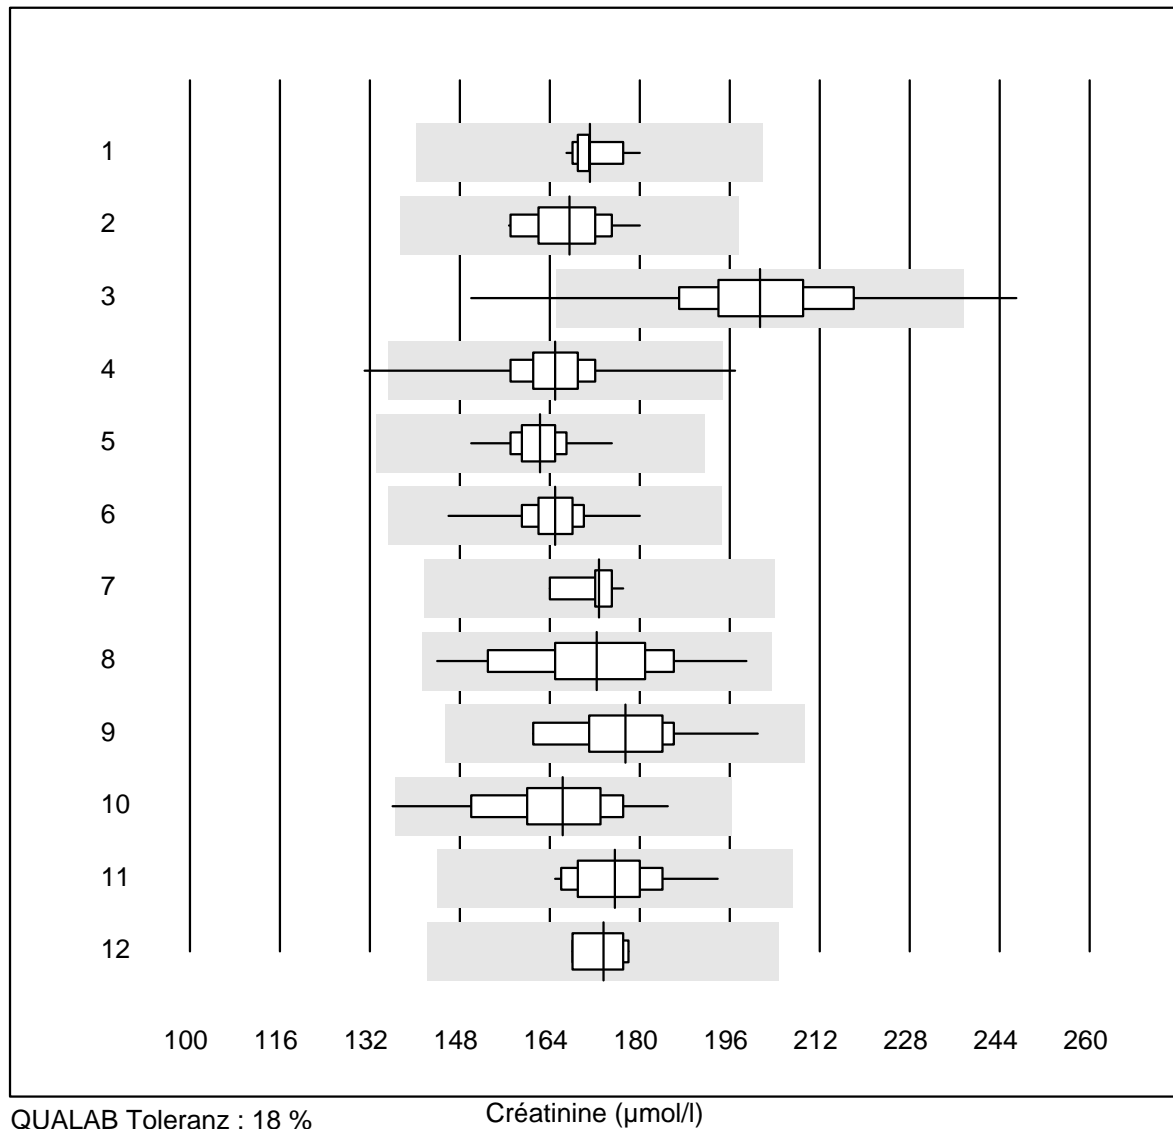


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	13	100.0	0.0	0.0	171	2.1	e
2	Cobas	20	100.0	0.0	0.0	167	4.1	e
3	Reflotron	684	96.9	1.5	1.6	201	6.5	e
4	Fuji Dri-Chem	927	99.3	0.4	0.3	165	3.9	e
5	Spotchem/Ready	85	98.8	0.0	1.2	162	2.8	e
6	Spotchem D-Concept	361	99.2	0.0	0.8	165	2.8	e
7	Enzymatisch	10	100.0	0.0	0.0	173	2.1	e
8	Piccolo	56	100.0	0.0	0.0	172	7.3	e
9	Abx Mira	10	100.0	0.0	0.0	177	6.6	e
10	Hitachi S40/M40	15	93.3	6.7	0.0	166	7.1	e
11	Autolyser/DiaSys	18	94.4	0.0	5.6	176	4.3	e
12	Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	174	2.9	e
13	EPOC	9	88.9	0.0	11.1	201	6.3	e

Créatinine E

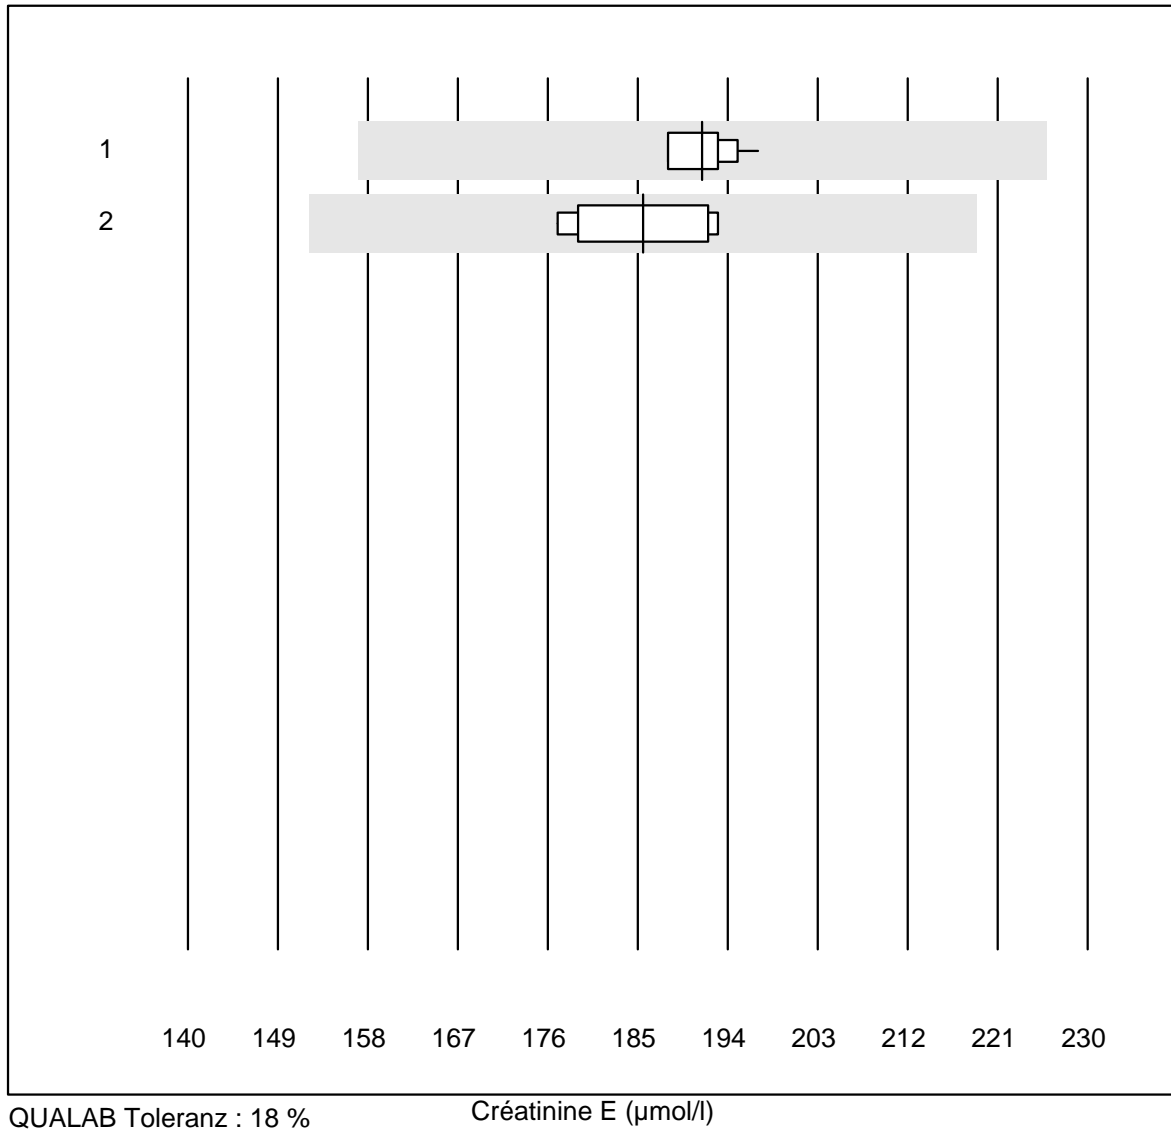

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	iStat Chem8	11	100.0	0.0	0.0	191	1.6	e
2	ABL700/800	8	87.5	0.0	12.5	186	3.2	e

eGFR CKD-EPI

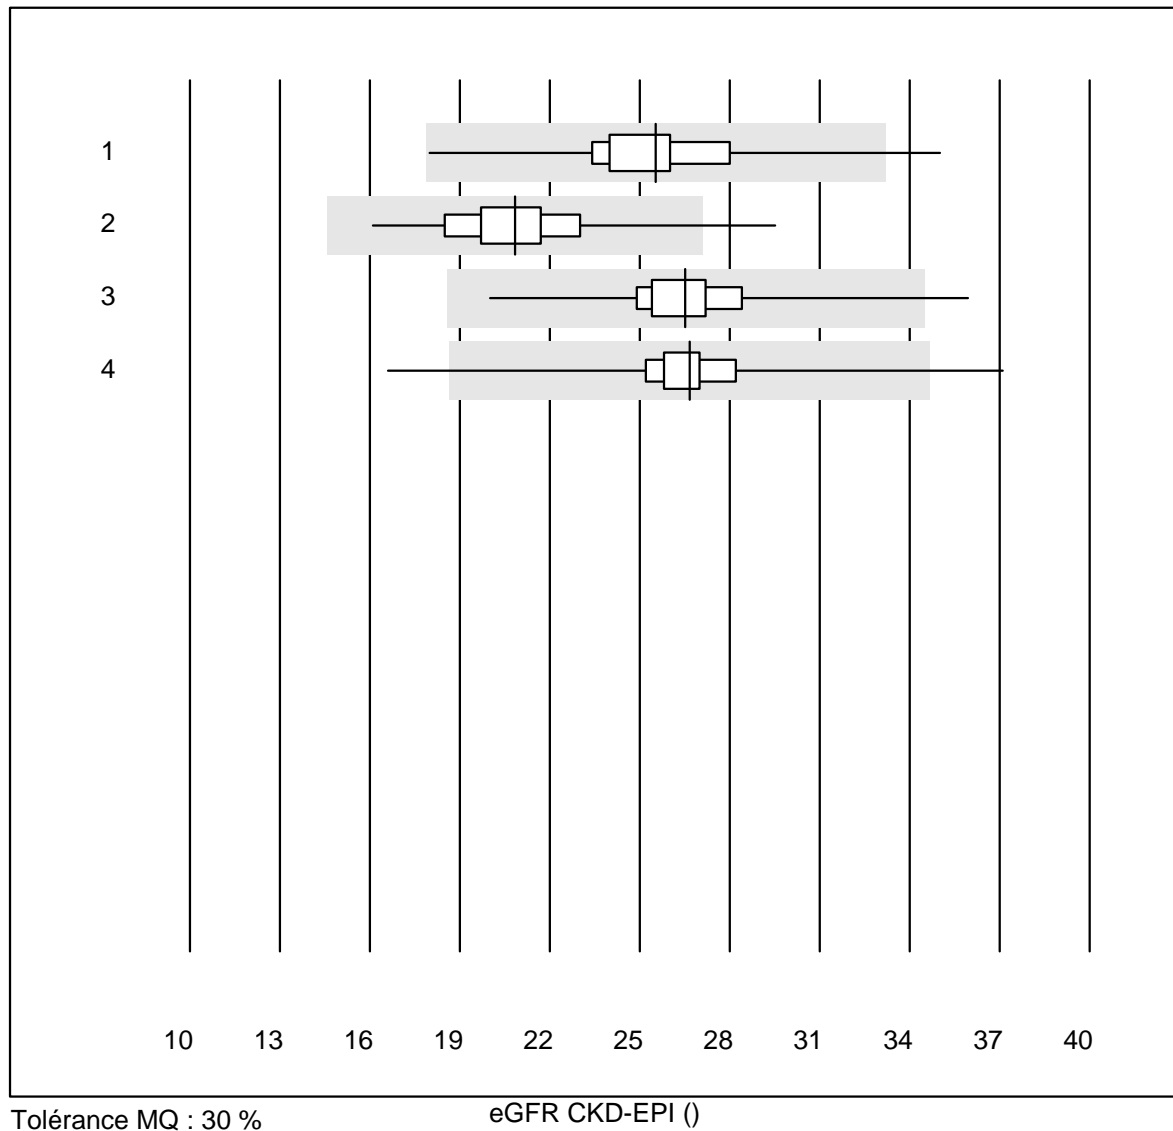


Tolérance MQ : 30 %

eGFR CKD-EPI ()

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	68	92.6	5.9	1.5	26	11.6	e
2	Reflotron	218	97.3	1.8	0.9	21	9.6	e
3	Fuji Dri-Chem	360	95.0	0.8	4.2	27	6.8	e
4	Spotchem/Ready	168	90.5	2.4	7.1	27	7.5	e

eGFR Cockcroft-Gault

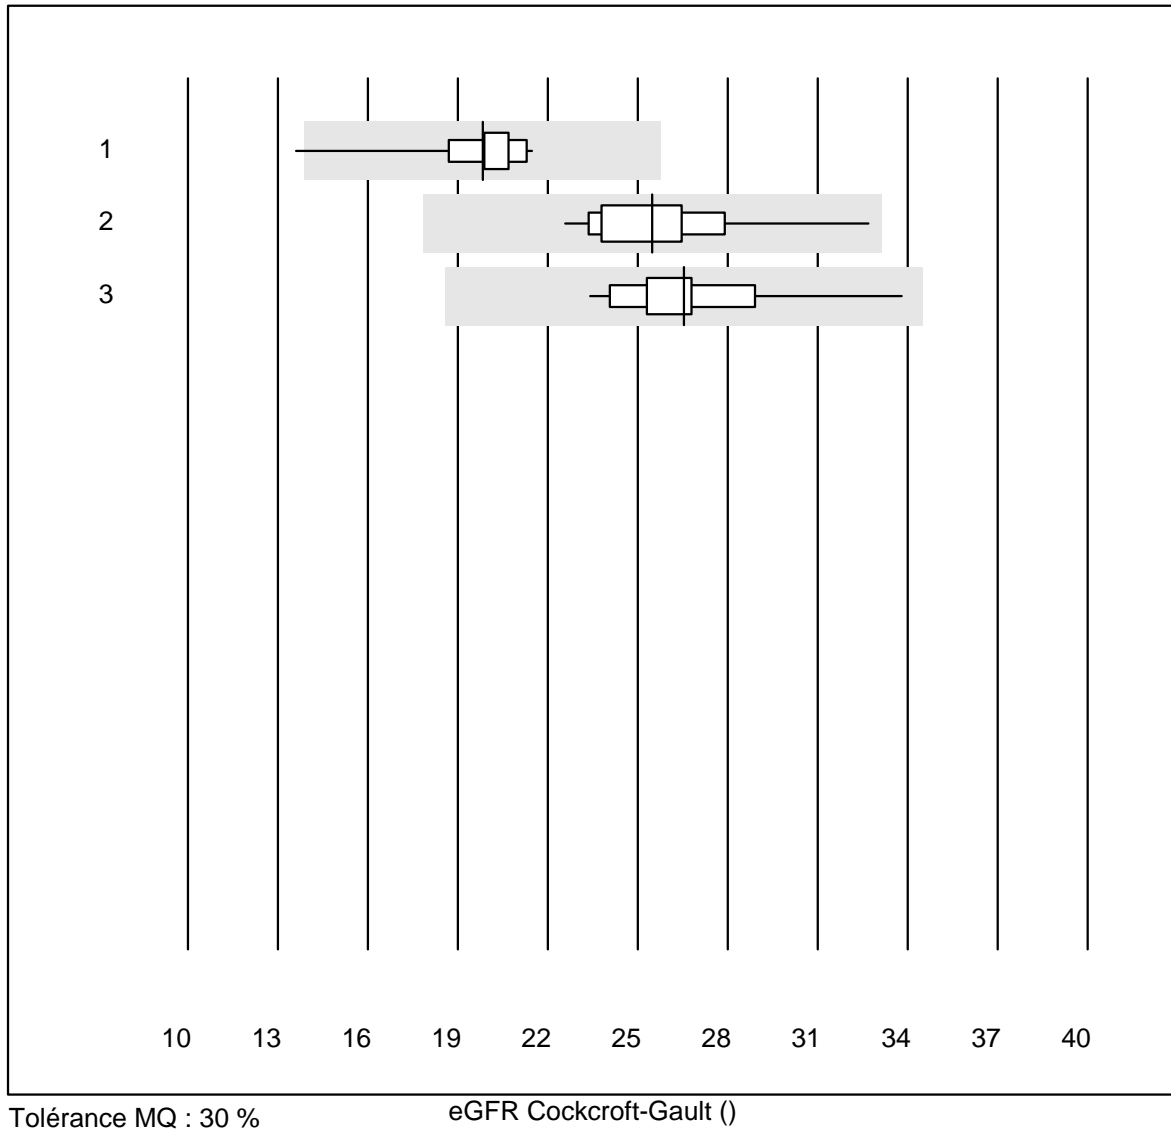


Tolérance MQ : 30 %

eGFR Cockcroft-Gault ()


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Reflotron	16	87.4	6.3	6.3	20	9.5	e
2	Fuji Dri-Chem	48	95.8	0.0	4.2	25	8.7	e
3	Spotchem/Ready	18	88.9	0.0	11.1	27	8.8	e

eGFR MDRD

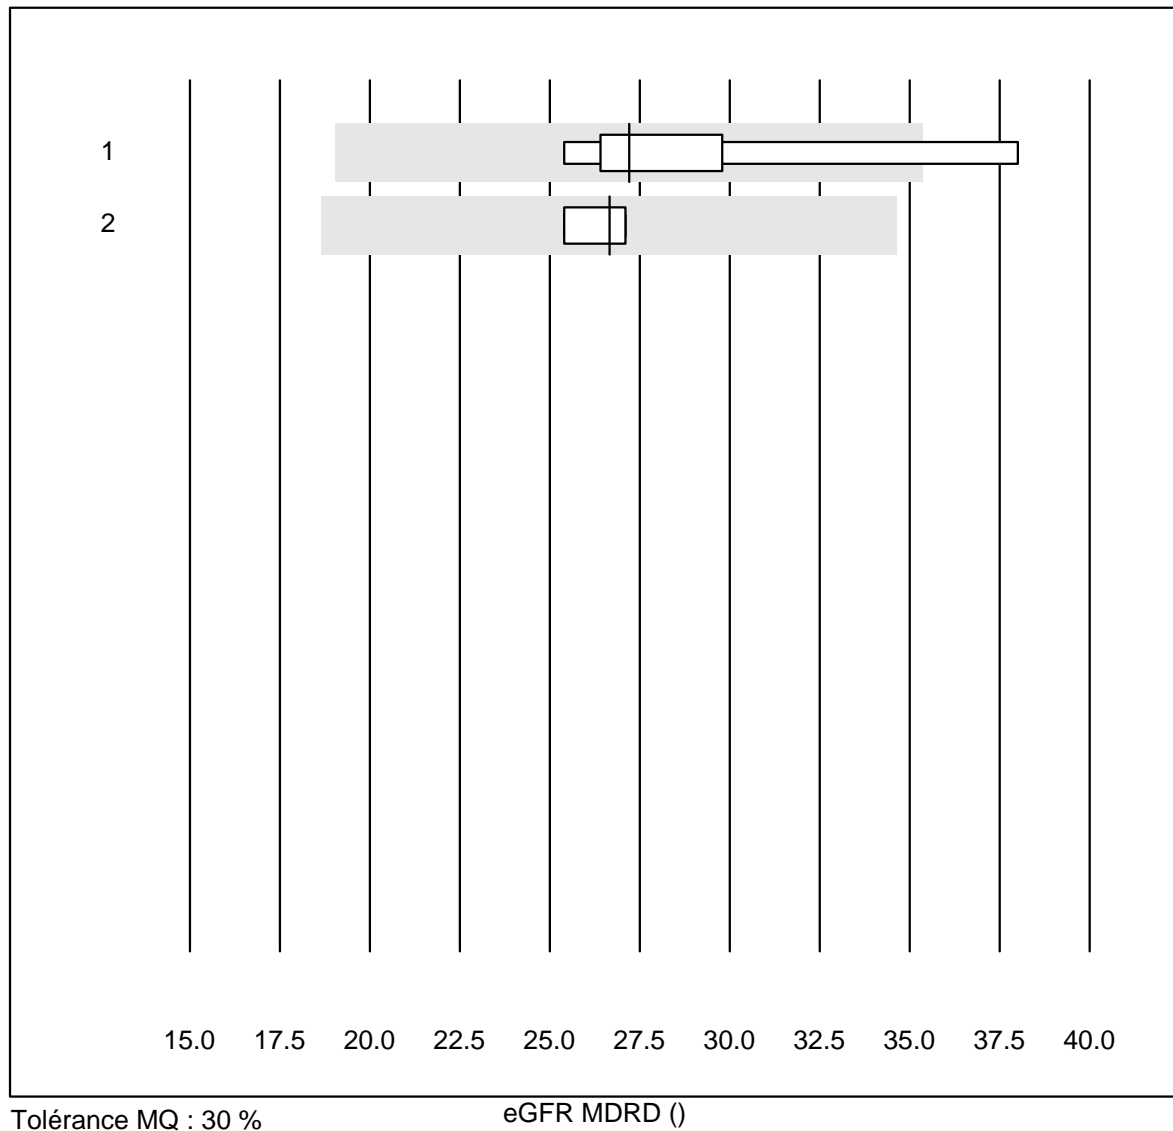


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Fuji Dri-Chem	6	66.6	16.7	16.7	27	17.0	e*
2	Spotchem/Ready	4	75.0	0.0	25.0	27	3.2	e

LDH

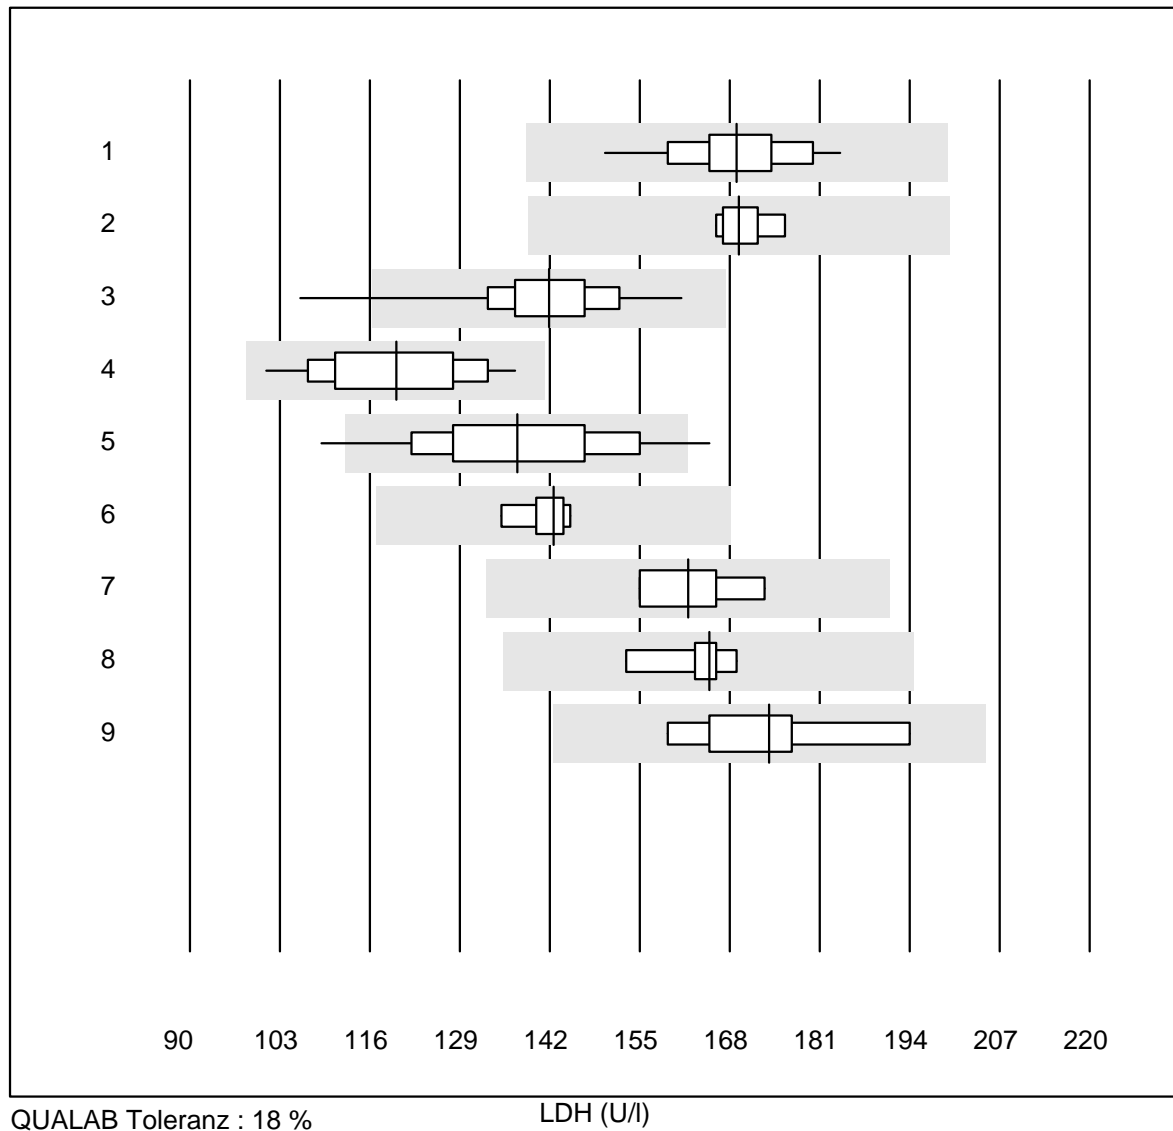

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	38	100.0	0.0	0.0	169	4.5	e
2 Cobas	6	100.0	0.0	0.0	169	2.2	e
3 Fuji Dri-Chem	141	99.3	0.7	0.0	142	5.7	e
4 Spotchem/Ready	13	100.0	0.0	0.0	120	9.2	e*
5 Spotchem D-Concept	47	95.7	4.3	0.0	137	9.3	e
6 Piccolo	6	100.0	0.0	0.0	143	2.6	e
7 Abx Mira	4	100.0	0.0	0.0	162	5.0	e*
8 Hitachi S40/M40	7	100.0	0.0	0.0	165	3.1	e
9 Autolysier/DiaSys	8	100.0	0.0	0.0	174	6.1	e*

Magnésium

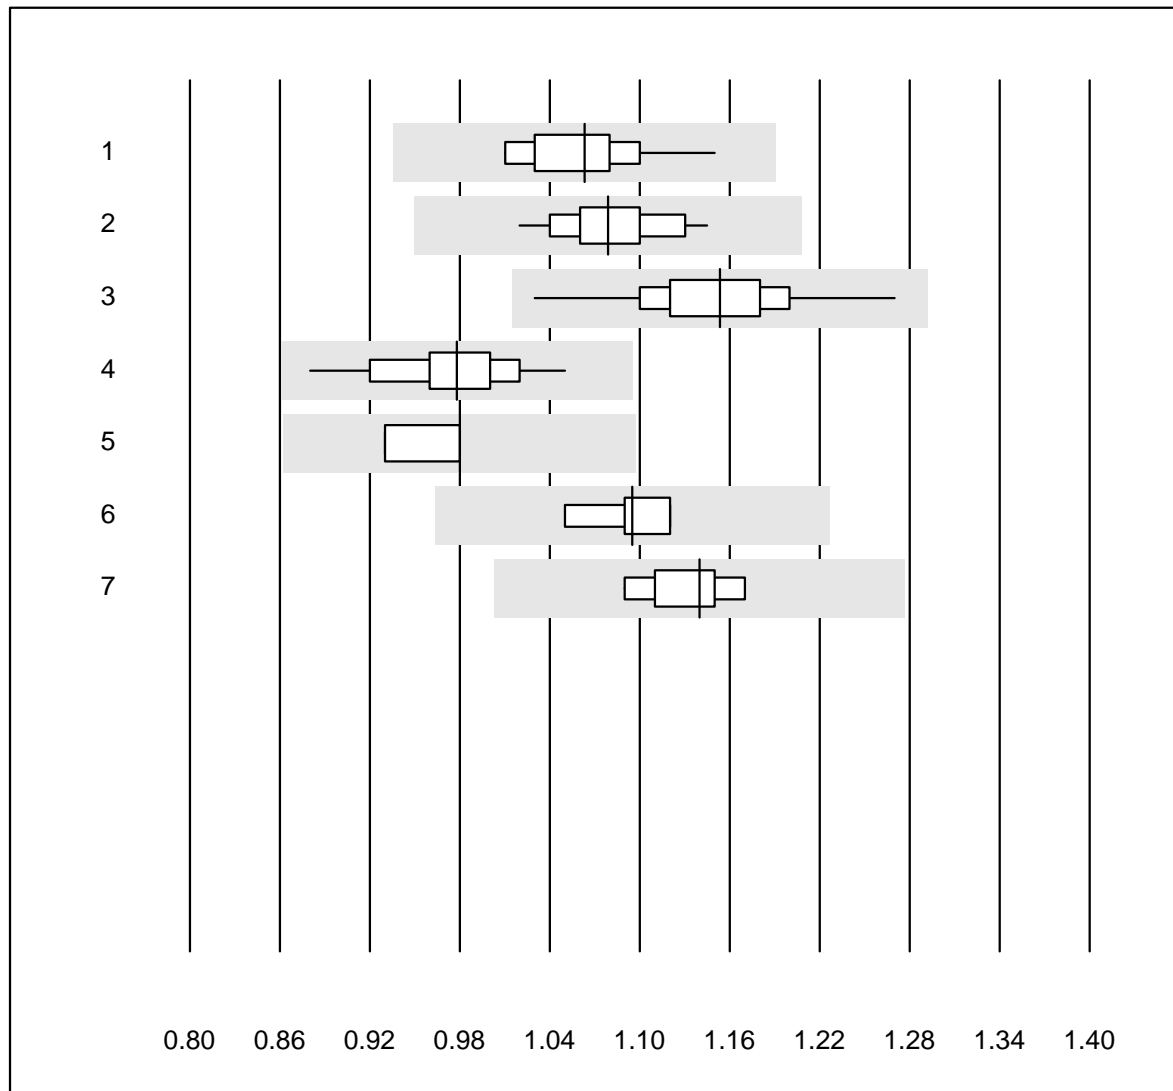


QUALAB Toleranz : 12 %

Magnésium (mmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	18	100.0	0.0	0.0	1.06	3.4	e
2	Cobas	15	100.0	0.0	0.0	1.08	3.0	e
3	Fuji Dri-Chem	109	98.2	0.0	1.8	1.15	3.7	e
4	Spotchem D-Concept	44	100.0	0.0	0.0	0.98	4.1	e
5	Spotchem/Ready	4	100.0	0.0	0.0	0.98	2.6	e
6	Beckman	6	100.0	0.0	0.0	1.10	2.4	e
7	Piccolo	8	100.0	0.0	0.0	1.14	2.2	e

Sodium

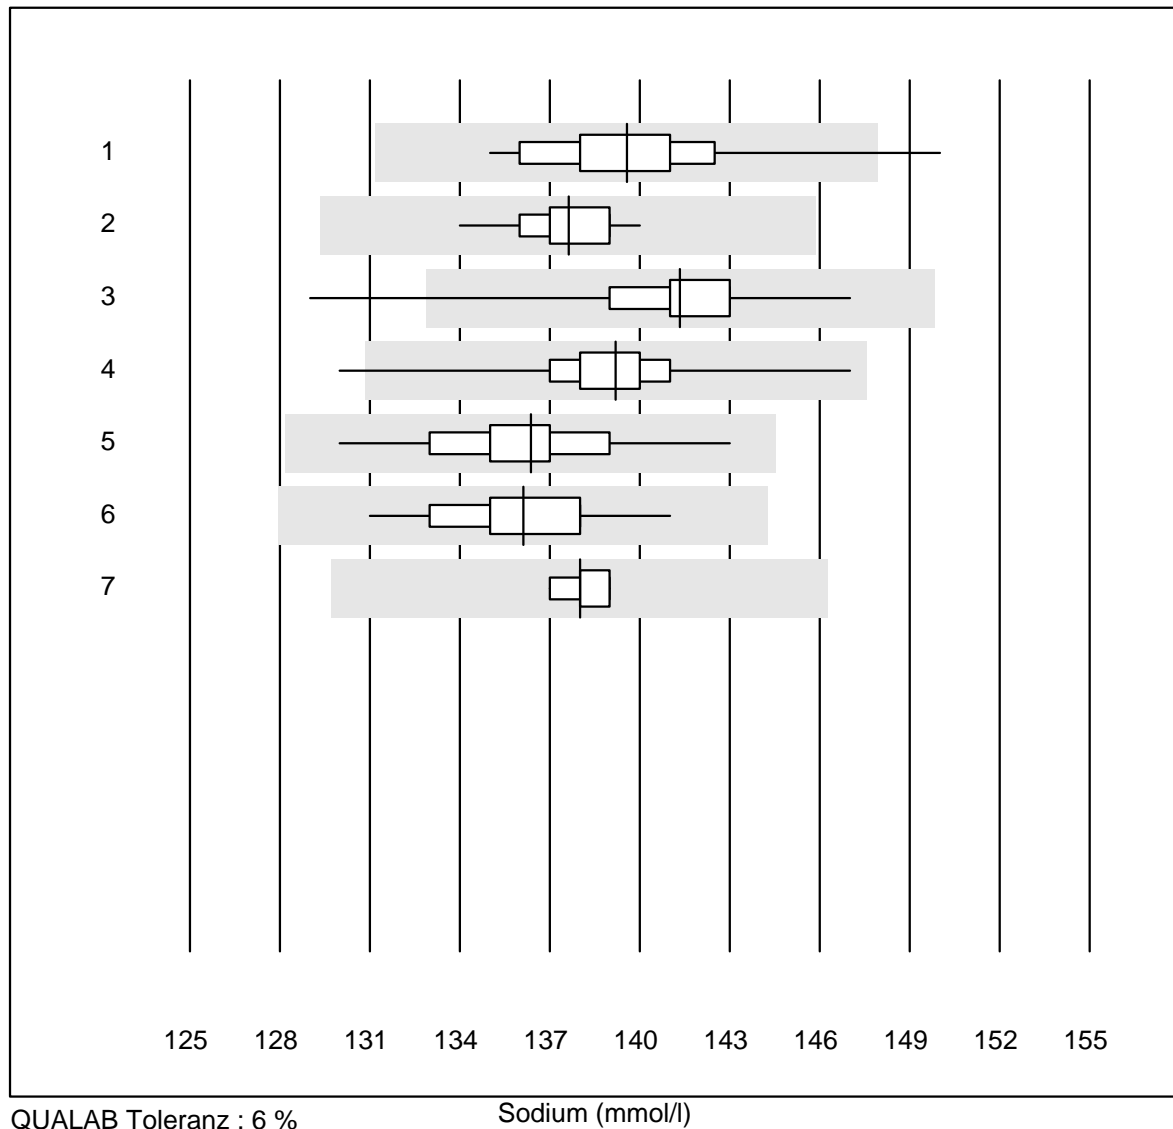

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ISE	39	97.4	2.6	0.0	140	2.1	e
2	Cobas	21	100.0	0.0	0.0	138	1.1	e
3	Fuji Dri-Chem	832	98.2	0.8	1.0	141	1.5	e
4	Spotchem D-Concept	318	99.7	0.3	0.0	139	1.4	e
5	Spotchem EL-SE 1520	67	98.5	0.0	1.5	136	1.7	e
6	Piccolo	39	100.0	0.0	0.0	136	1.6	e
7	iStat Chem8	6	100.0	0.0	0.0	138	0.5	e

Phosphates

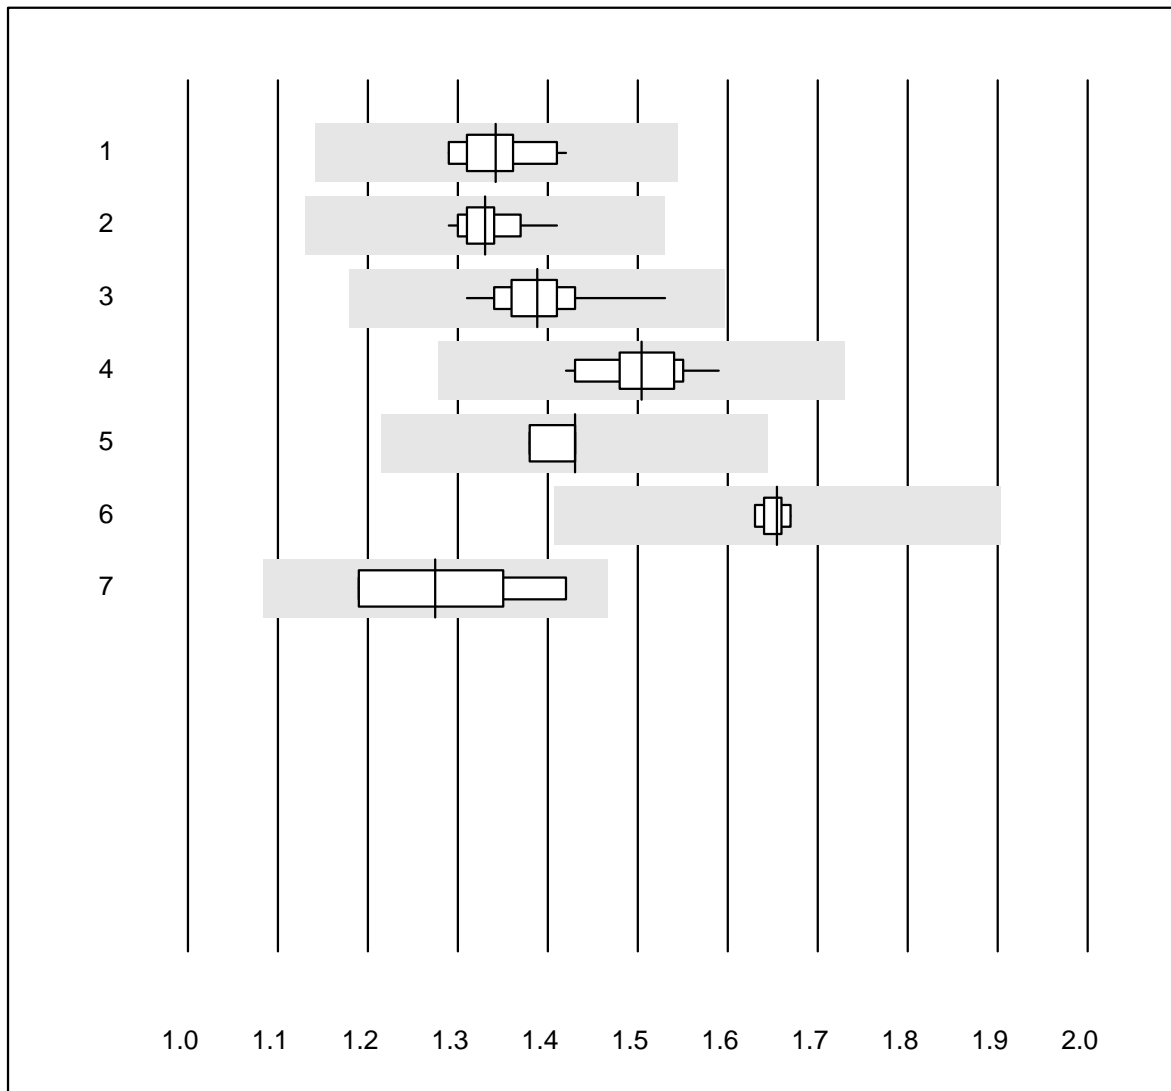


QUALAB Toleranz : 15 %

Phosphates (mmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	23	100.0	0.0	0.0	1.3	2.9	e
2	Cobas	18	100.0	0.0	0.0	1.3	2.3	e
3	Fuji Dri-Chem	82	98.8	0.0	1.2	1.4	3.0	e
4	Spotchem D-Concept	19	94.7	0.0	5.3	1.5	2.9	e
5	Spotchem/Ready	4	100.0	0.0	0.0	1.4	1.8	e
6	Piccolo	6	100.0	0.0	0.0	1.7	0.9	e
7	Hitachi S40/M40	4	100.0	0.0	0.0	1.3	8.8	e*

Protéine

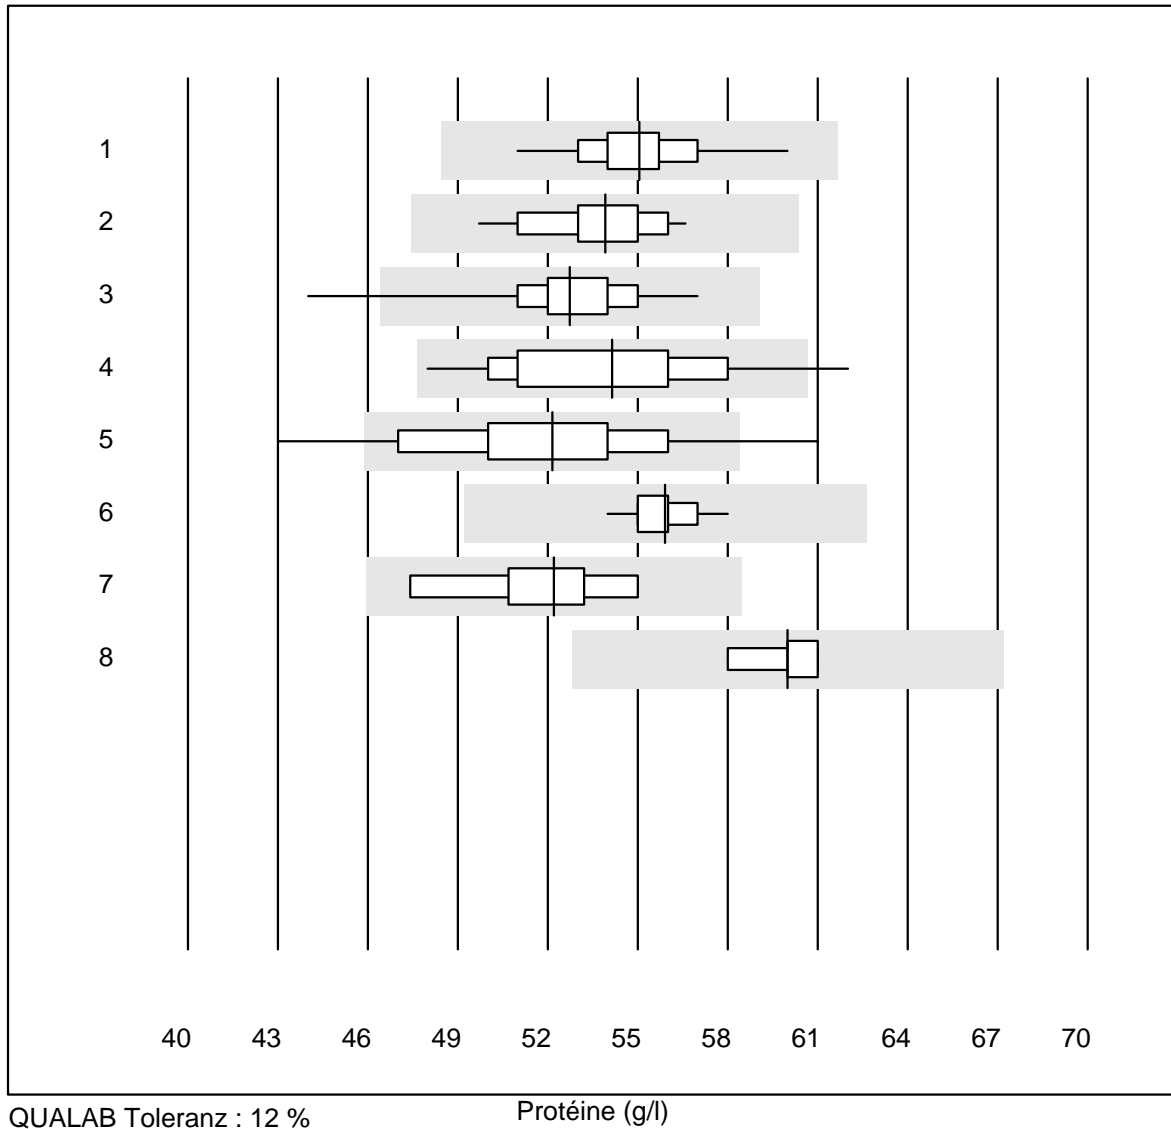

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	23	100.0	0.0	0.0	55.1	3.3	e
2	Cobas	17	100.0	0.0	0.0	53.9	3.5	e
3	Fuji Dri-Chem	182	97.8	1.1	1.1	52.7	3.3	e
4	Spotchem/Ready	28	96.4	3.6	0.0	54.1	6.2	e
5	Spotchem D-Concept	128	89.0	5.5	5.5	52.1	6.6	e
6	Piccolo	37	100.0	0.0	0.0	55.9	1.6	e
7	Abx Mira	5	100.0	0.0	0.0	52.2	5.5	e*
8	Hitachi S40/M40	6	100.0	0.0	0.0	60.0	1.8	e

Transaminase GOT/AST

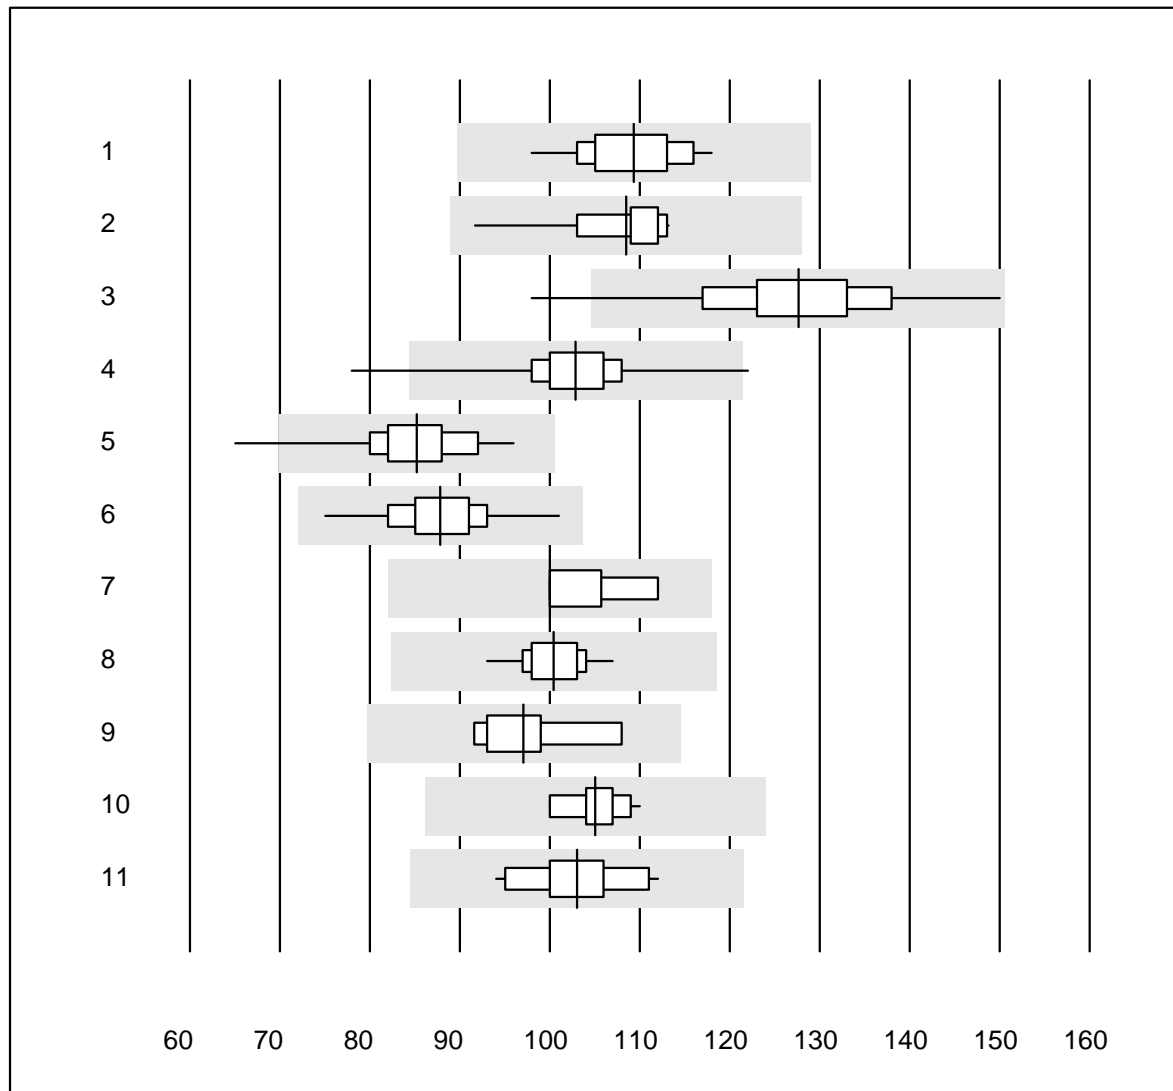


QUALAB Toleranz : 18 %

Transaminase GOT/AST (U/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC avec PP	27	100.0	0.0	0.0	109	4.5	e
2 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	108	4.8	e
3 Reflotron	590	98.4	0.8	0.8	128	6.7	e
4 Fuji Dri-Chem	905	99.0	0.4	0.6	103	4.2	e
5 Spotchem/Ready	81	98.8	1.2	0.0	85	5.6	e
6 Spotchem D-Concept	360	99.2	0.0	0.8	88	4.6	e
7 IFCC sens PP	5	100.0	0.0	0.0	100	5.2	e*
8 Piccolo	58	100.0	0.0	0.0	100	3.0	e
9 Abx Mira	8	100.0	0.0	0.0	97	5.8	e
10 Hitachi S40/M40	15	100.0	0.0	0.0	105	2.9	e
11 Autolyser/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	103	5.2	e

Transaminase GPT/ALT

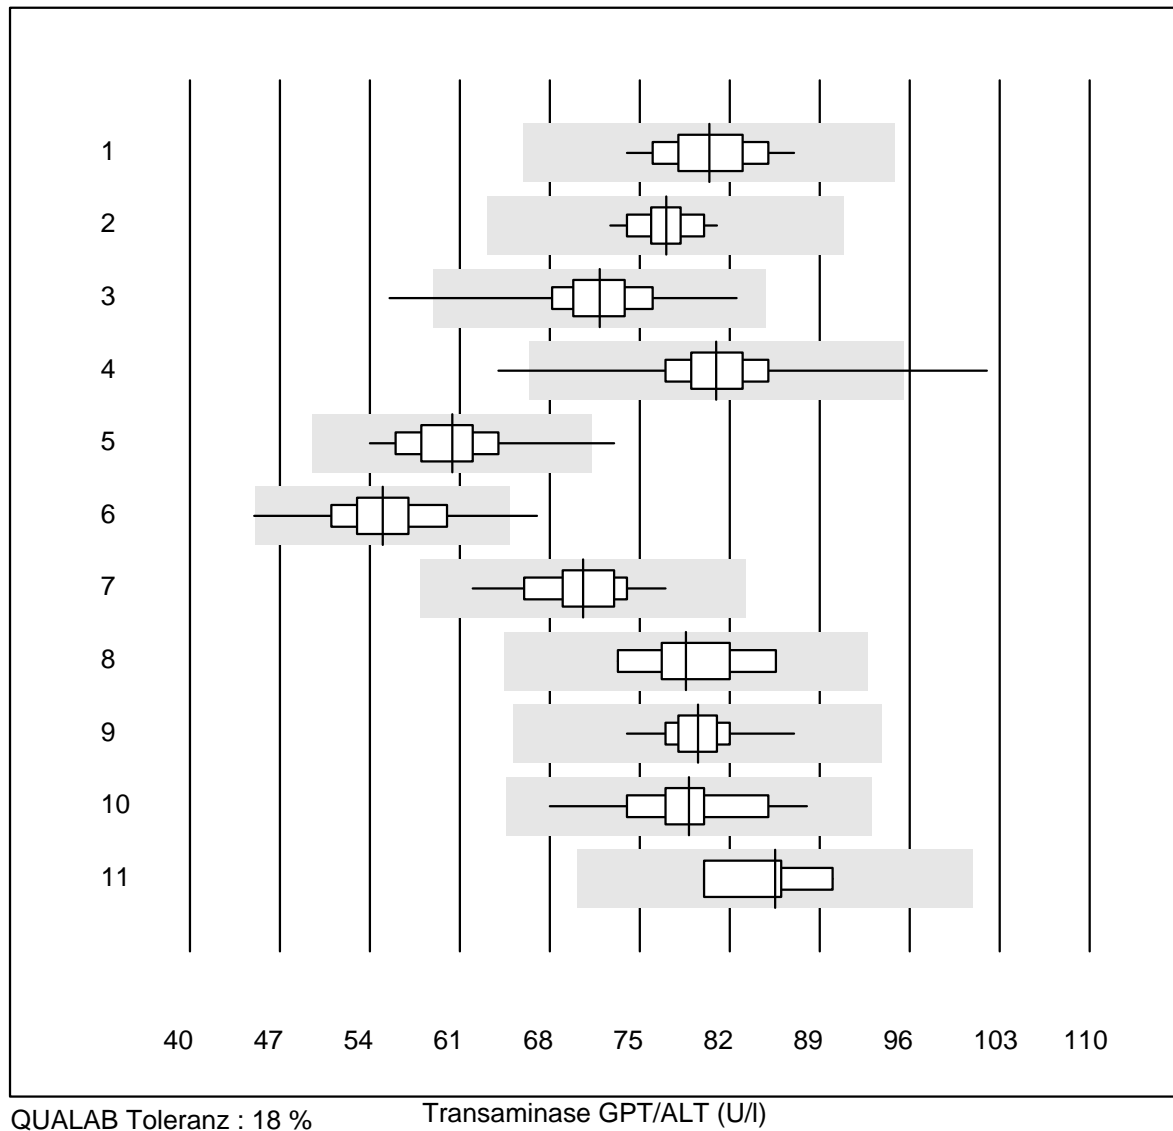

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC avec PP	25	100.0	0.0	0.0	80	4.5	e
2 Cobas	22	100.0	0.0	0.0	77	2.9	e
3 Reflotron	609	98.7	0.5	0.8	72	4.8	e
4 Fuji Dri-Chem	917	98.8	0.4	0.8	81	4.6	e
5 Spotchem/Ready	84	98.8	1.2	0.0	60	5.5	e
6 Spotchem D-Concept	364	97.0	1.9	1.1	55	6.4	e
7 Piccolo	57	100.0	0.0	0.0	71	4.6	e
8 Abx Mira	7	100.0	0.0	0.0	79	5.0	e
9 Hitachi S40/M40	16	100.0	0.0	0.0	80	3.6	e
10 Autolyser/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	79	5.5	e
11 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	86	4.8	e*

Triglycérides

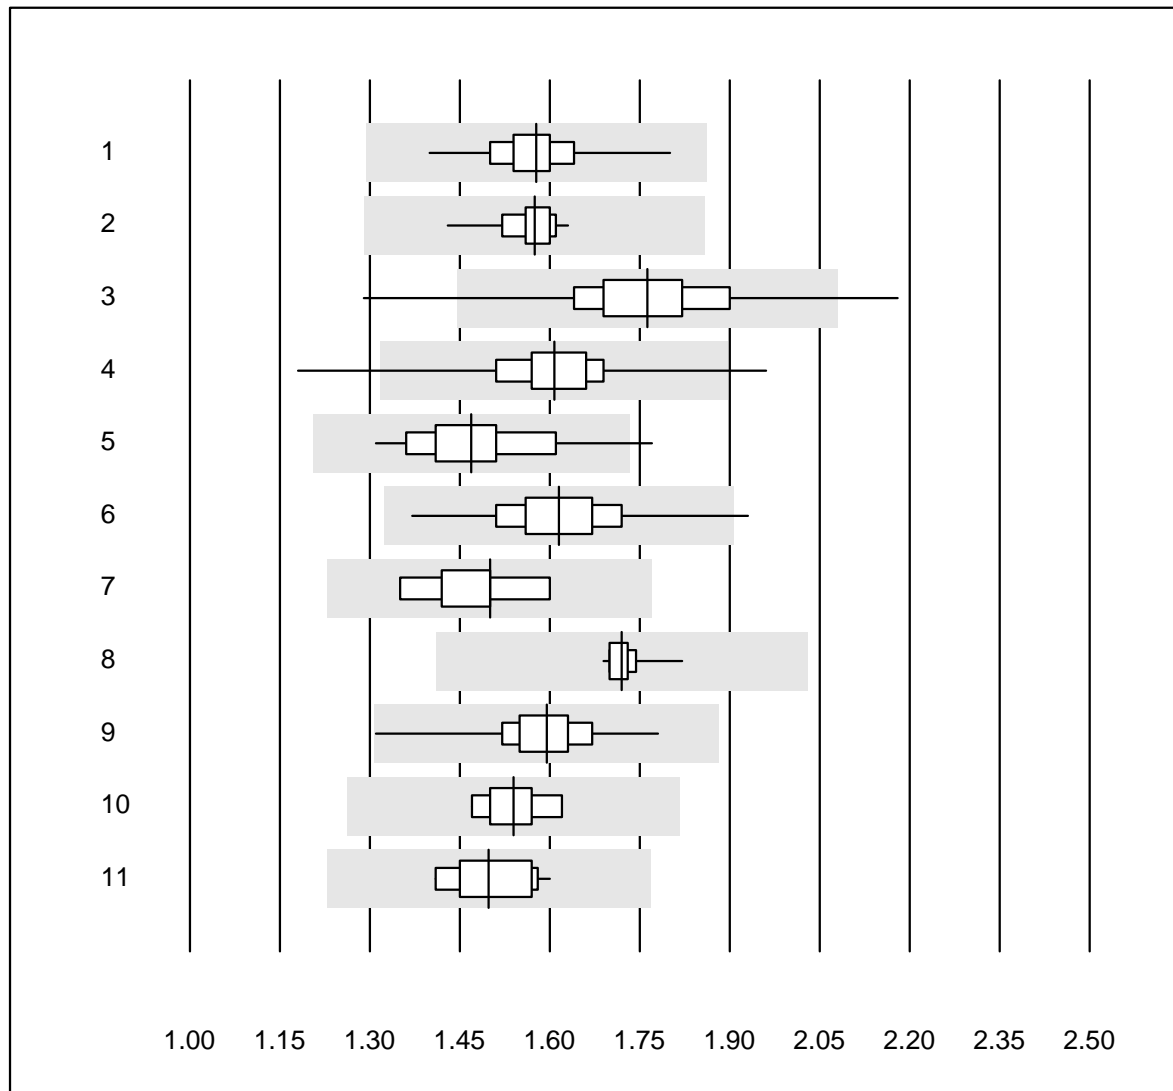


QUALAB Toleranz : 18 %

Triglycérides (mmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	26	100.0	0.0	0.0	1.58	4.7	e
2	Cobas	21	100.0	0.0	0.0	1.58	2.9	e
3	Reflotron	291	94.2	2.4	3.4	1.76	6.6	e
4	Fuji Dri-Chem	795	98.9	0.3	0.8	1.61	4.4	e
5	Spotchem/Ready	70	95.7	2.9	1.4	1.47	6.4	e
6	Spotchem D-Concept	315	97.8	0.3	1.9	1.62	5.3	e
7	Hitachi S40/M40	9	88.9	0.0	11.1	1.50	5.2	e
8	Piccolo	18	100.0	0.0	0.0	1.72	1.7	e
9	Cholestech LDX	315	99.4	0.0	0.6	1.59	3.8	e
10	Abx Mira	6	100.0	0.0	0.0	1.54	3.6	e
11	Autolyser/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	1.50	4.2	e

Lithium

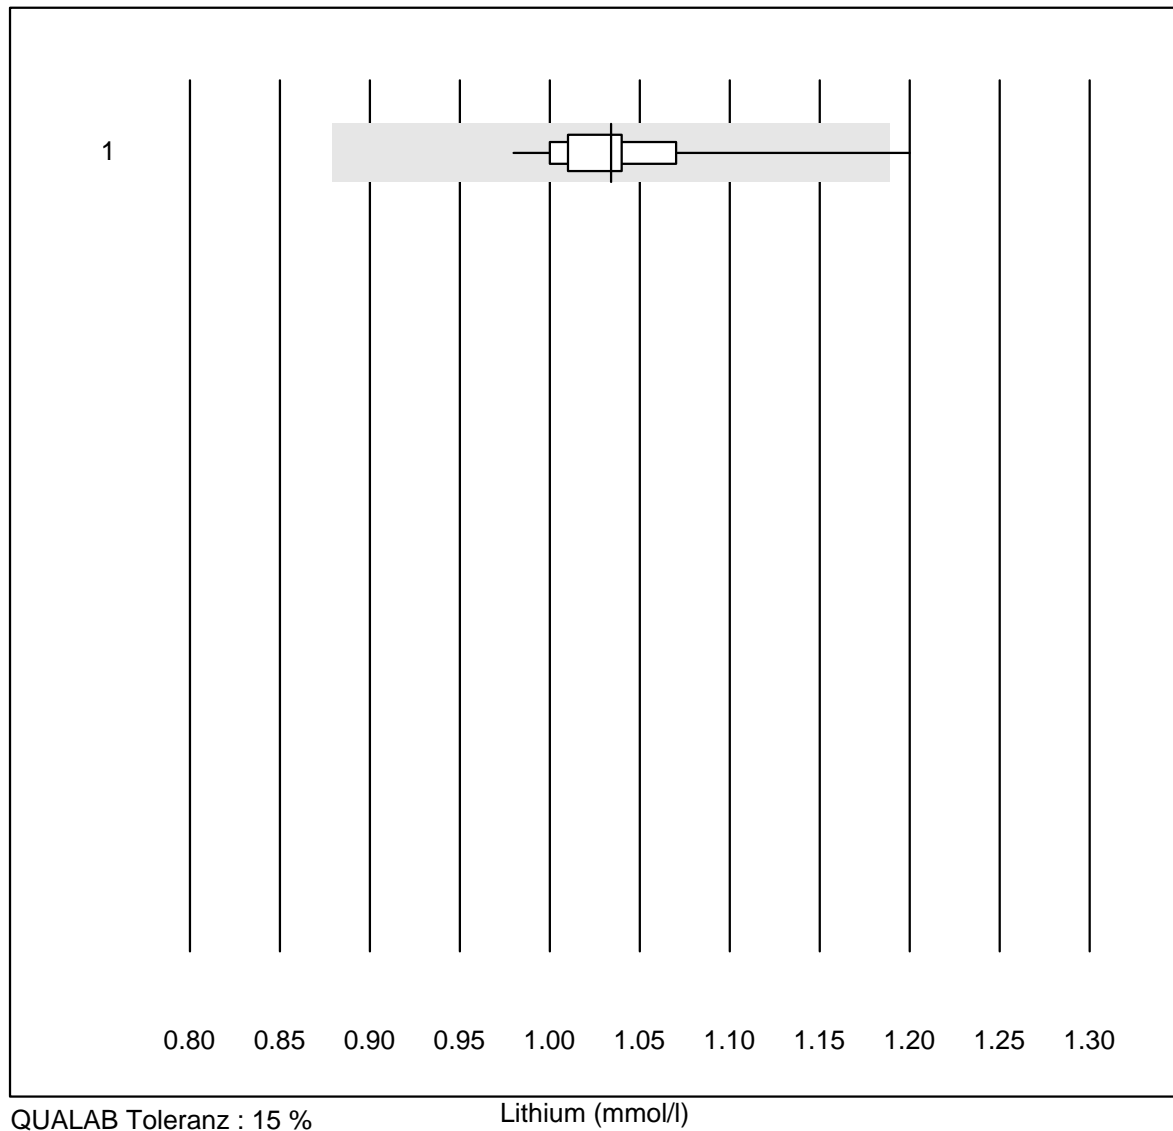


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	17	94.1	5.9	0.0	1.03	4.7	e

Laktat

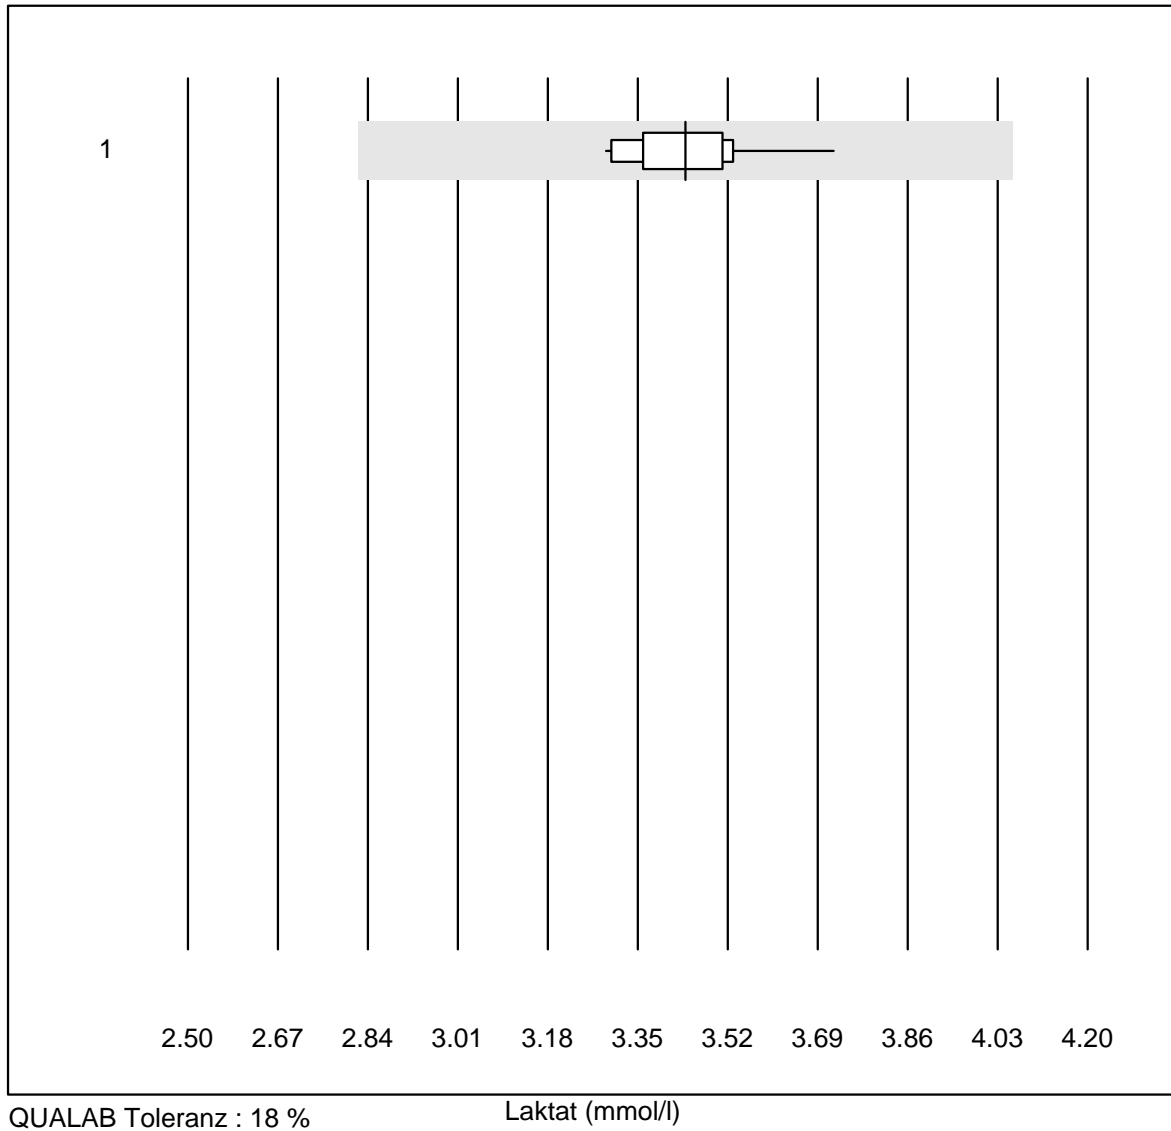

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	13	100.0	0.0	0.0	3.44	3.4	e

HbA1c échantillon A

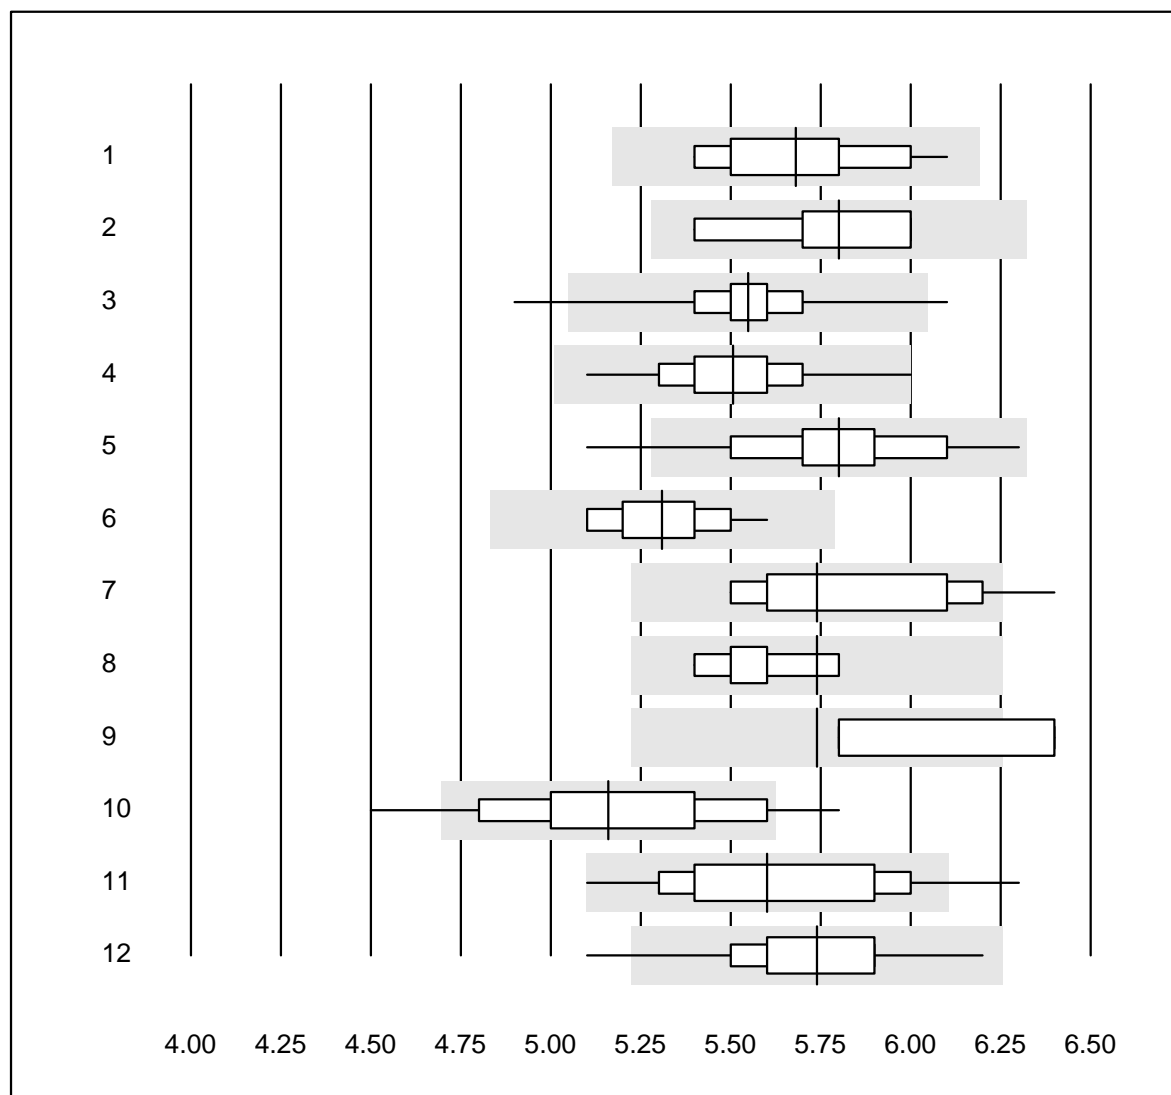


QUALAB Toleranz : 9 %

HbA1c échantillon A (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Roche, Cobas	17	100.0	0.0	0.0	5.7	3.6	e
2	HPLC	7	100.0	0.0	0.0	5.8	3.6	e*
3	Afinion	584	98.3	1.2	0.5	5.5	2.7	e
4	Cobas b101	134	99.3	0.0	0.7	5.5	3.2	e
5	DCA2000/Vantage	159	98.1	1.3	0.6	5.8	3.4	e
6	Celltac chemi	21	100.0	0.0	0.0	5.3	2.9	e
7	NycoCard	24	91.6	4.2	4.2	5.7	4.7	a
8	Eurolyser	10	80.0	0.0	20.0	5.7	2.1	a
9	Hemocue HbA1c 501	4	50.0	25.0	25.0	5.7	5.8	a
10	A1c Now	220	80.4	11.4	8.2	5.2	5.8	e
11	AFIAS	47	87.2	8.5	4.3	5.6	5.3	e
12	Andere	18	94.4	5.6	0.0	5.7	4.2	a
13	Spinit	9	100.0	0.0	0.0	5.7	2.3	e


HbA1c échantillon B

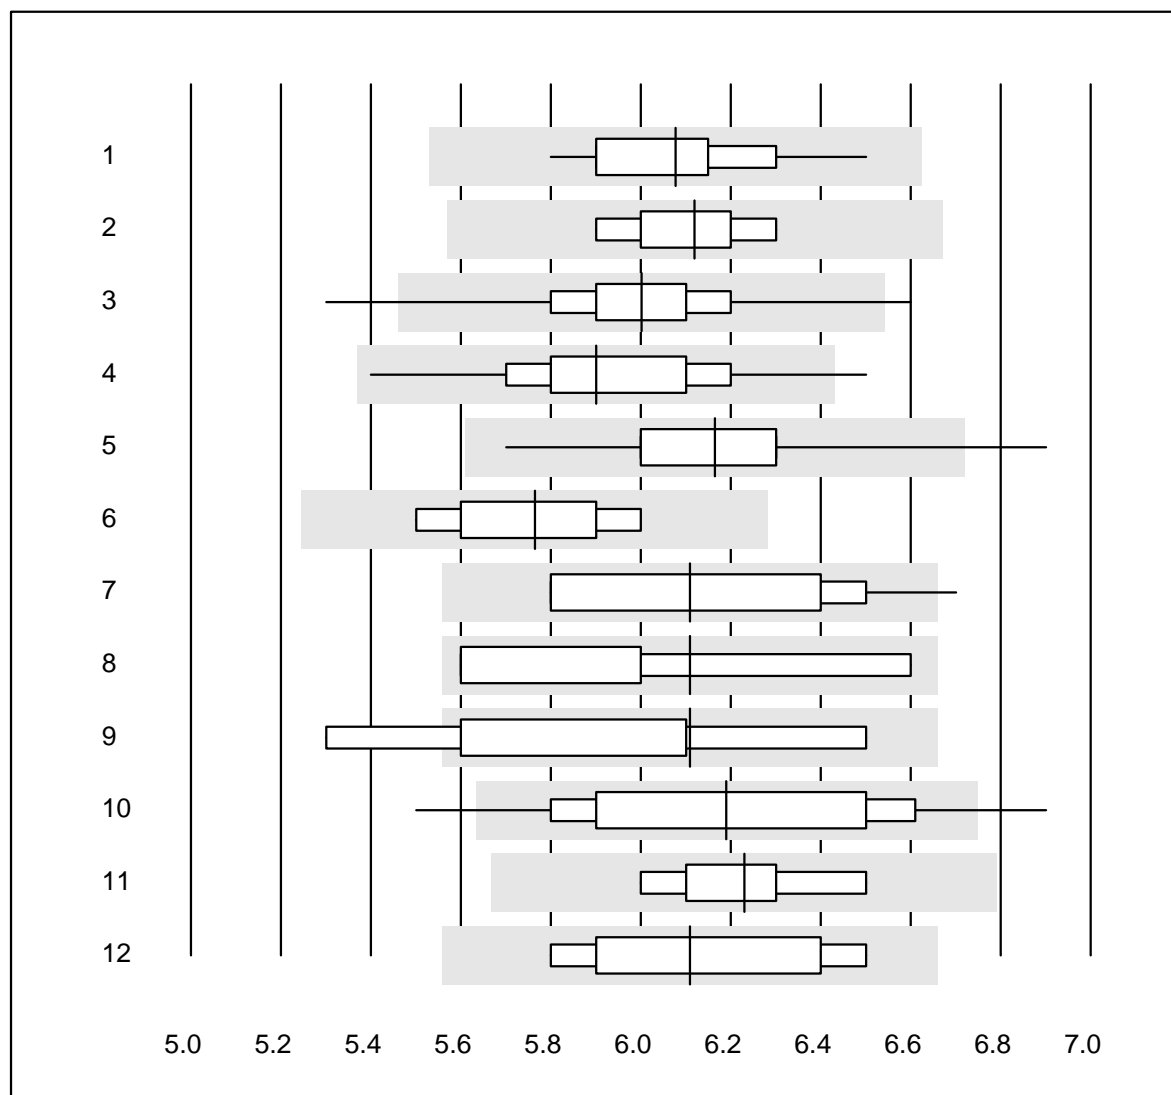

QUALAB Toleranz : 9 %


HbA1c échantillon B (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Roche, Cobas	16	100.0	0.0	0.0	6.1	2.9	e
2	HPLC	7	100.0	0.0	0.0	6.1	2.2	e
3	Afinion	783	99.4	0.3	0.3	6.0	2.5	e
4	Cobas b101	144	99.3	0.7	0.0	5.9	3.2	e
5	DCA2000/Vantage	218	98.6	0.5	0.9	6.2	2.7	e
6	Celltac chemi	14	100.0	0.0	0.0	5.8	2.9	e
7	NycoCard	10	90.0	10.0	0.0	6.1	5.1	a
8	Eurolyser	8	100.0	0.0	0.0	6.1	5.7	a
9	A1c Now	7	71.4	14.3	14.3	6.1	7.3	a
10	AFIAS	64	85.9	12.5	1.6	6.2	5.7	e
11	Spinit	10	100.0	0.0	0.0	6.2	2.8	e
12	Andere	15	100.0	0.0	0.0	6.1	4.0	a

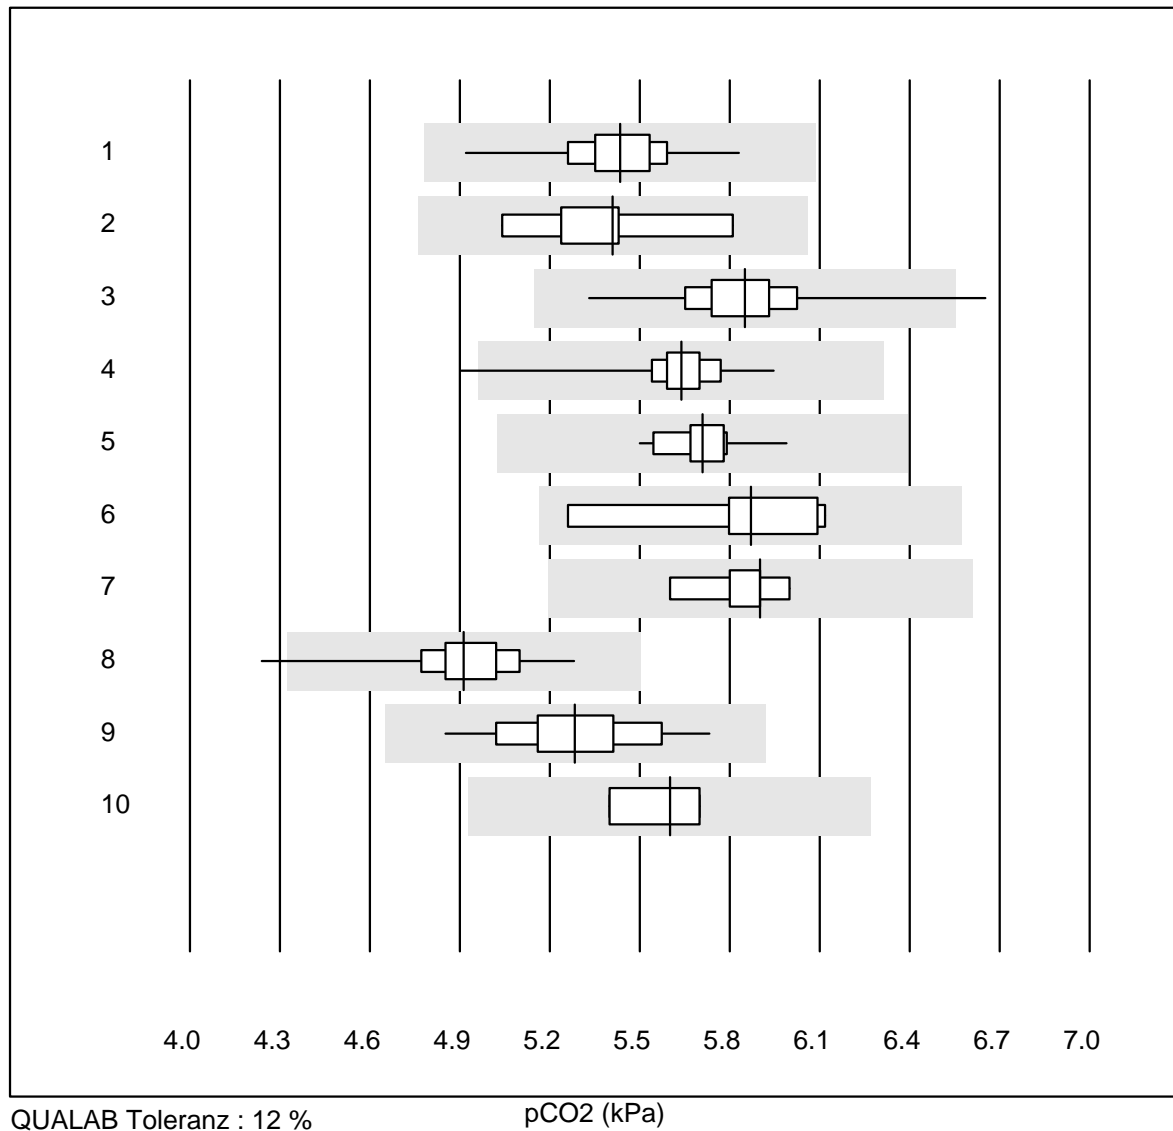pCO₂


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 ABL700/800	91	100.0	0.0	0.0	5.43	2.6	e
2 ABL80 FLEX	8	100.0	0.0	0.0	5.41	4.3	e*
3 ABL80 FLEX CO-OX / O	15	93.3	6.7	0.0	5.85	4.7	e
4 ABL90 FLEX / PLUS	79	98.7	1.3	0.0	5.64	2.4	e
5 Cobas b 123	14	100.0	0.0	0.0	5.71	2.1	e
6 Cobas b 221	7	100.0	0.0	0.0	5.87	4.9	e*
7 GEM	5	100.0	0.0	0.0	5.90	2.6	e
8 iStat	42	97.6	2.4	0.0	4.91	3.6	e
9 EPOC	49	100.0	0.0	0.0	5.28	3.8	e
10 IL	4	100.0	0.0	0.0	5.60	2.7	e

pO2

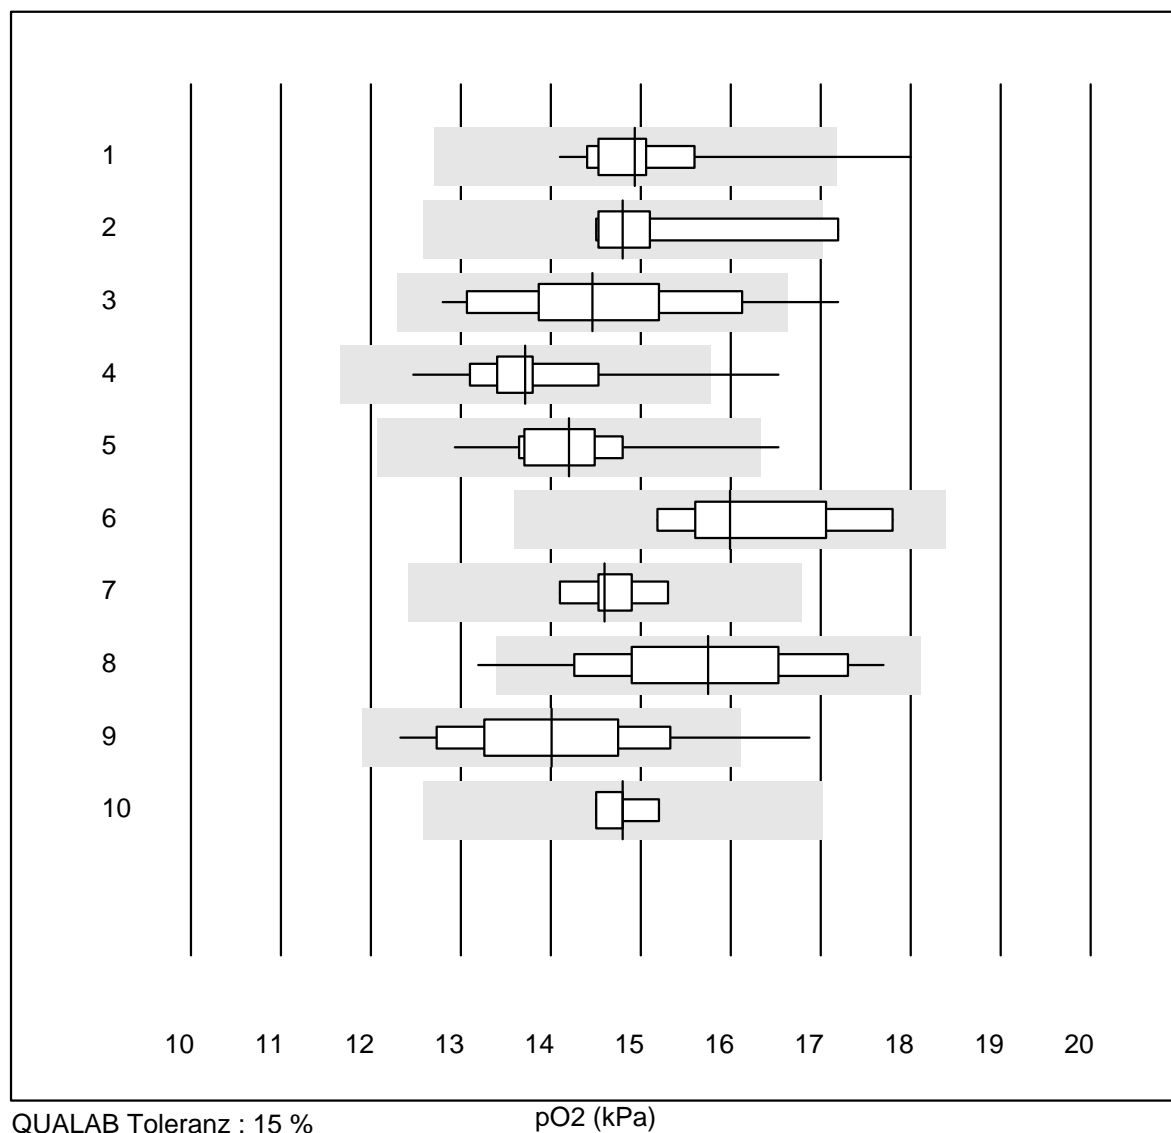

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL700/800	91	97.8	2.2	0.0	14.93	4.3	e
2	ABL80 FLEX	8	87.5	12.5	0.0	14.80	6.2	e*
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	15	93.3	6.7	0.0	14.47	8.0	e*
4	ABL90 FLEX / PLUS	80	93.7	2.5	3.8	13.71	5.1	e
5	Cobas b 123	14	92.9	7.1	0.0	14.20	5.8	e
6	Cobas b 221	7	85.7	0.0	14.3	15.99	5.9	e*
7	GEM	5	100.0	0.0	0.0	14.60	3.0	e
8	iStat	40	95.0	2.5	2.5	15.75	7.1	e
9	EPOC	49	93.9	2.0	4.1	14.01	7.2	e
10	IL	4	100.0	0.0	0.0	14.80	1.9	e

pH

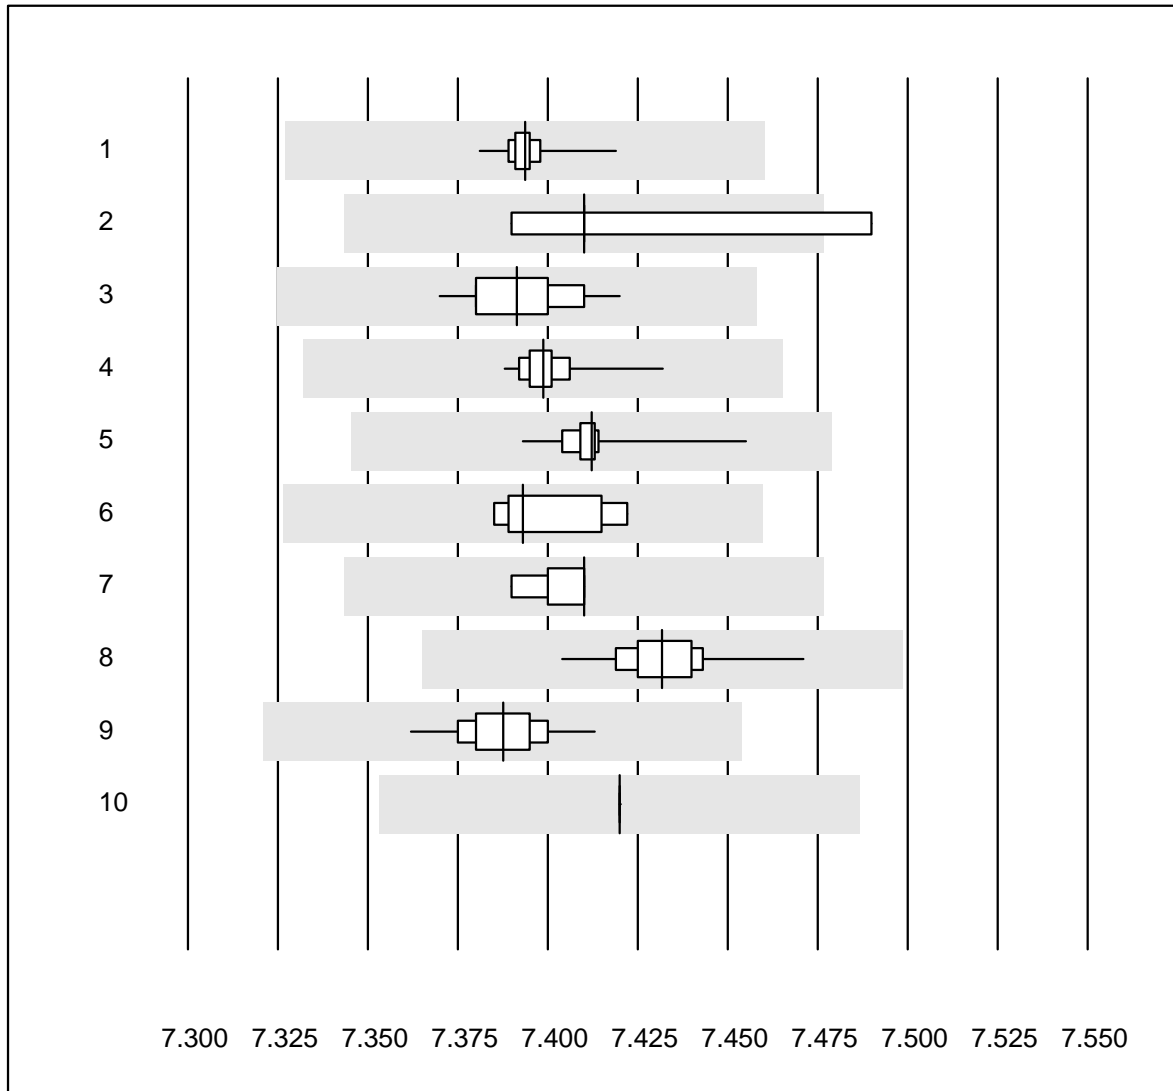


QUALAB Toleranz : 1 %

pH ()

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL700/800	91	100.0	0.0	0.0	7.39	0.1	e
2	ABL80 FLEX	8	87.5	12.5	0.0	7.41	0.4	e*
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	14	100.0	0.0	0.0	7.39	0.2	e
4	ABL90 FLEX / PLUS	80	100.0	0.0	0.0	7.40	0.1	e
5	Cobas b 123	14	100.0	0.0	0.0	7.41	0.2	e
6	Cobas b 221	7	100.0	0.0	0.0	7.39	0.2	e
7	GEM	5	100.0	0.0	0.0	7.41	0.1	e
8	iStat	43	100.0	0.0	0.0	7.43	0.2	e
9	EPOC	48	100.0	0.0	0.0	7.39	0.1	e
10	IL	4	100.0	0.0	0.0	7.42	0.0	e

Glucose GS

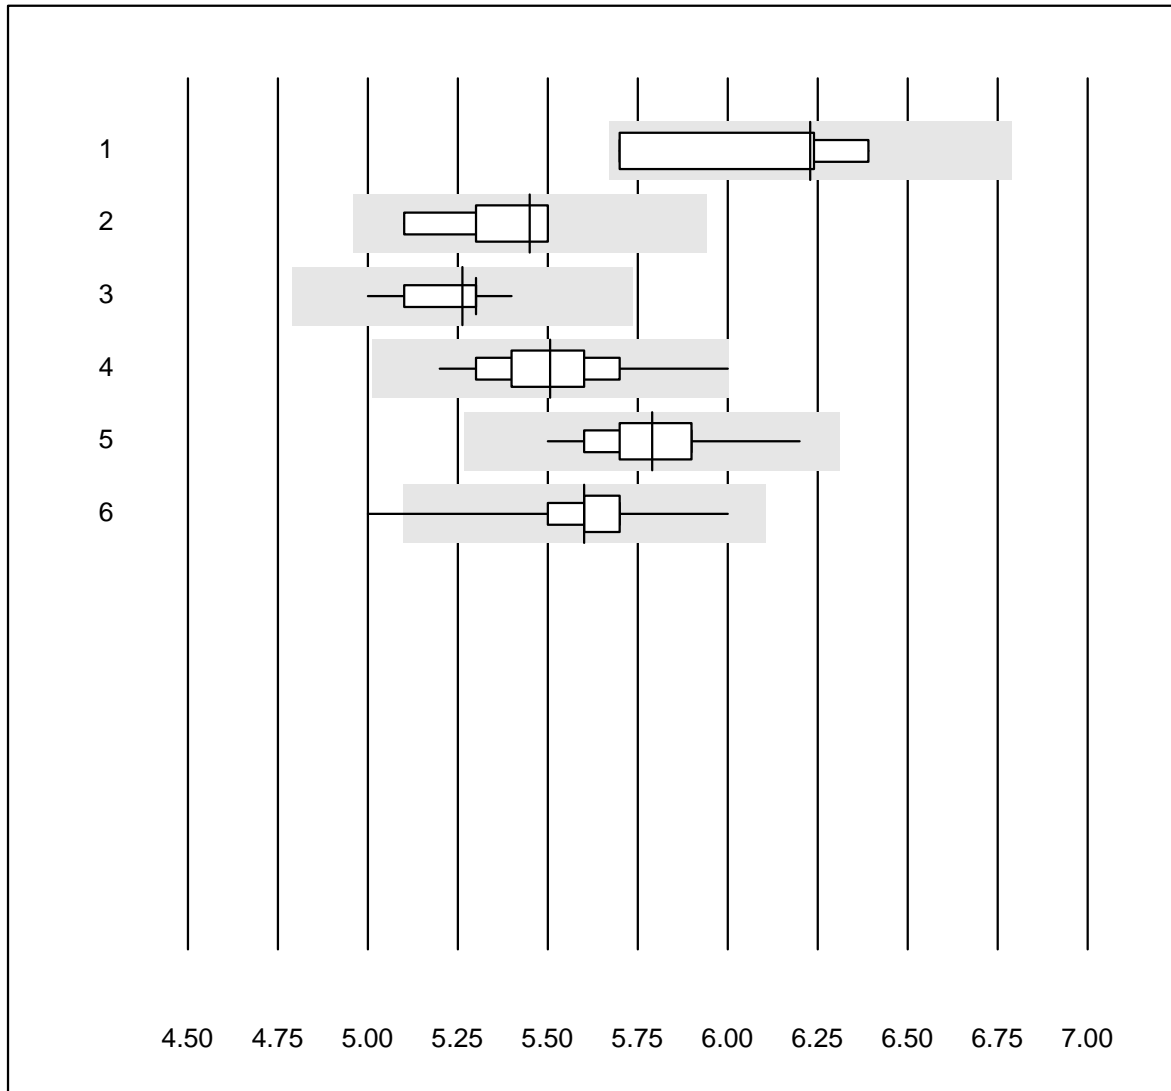


QUALAB Toleranz : 9 %

Glucose GS (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas b 221	4	100.0	0.0	0.0	6.2	4.9	e*
2 Cobas b 123	8	100.0	0.0	0.0	5.5	2.6	e
3 iStat	12	91.7	0.0	8.3	5.3	2.1	e
4 EPOC	35	100.0	0.0	0.0	5.5	3.3	e
5 ABL700/800	84	100.0	0.0	0.0	5.8	2.4	e
6 ABL90 FLEX / PLUS	78	96.1	1.3	2.6	5.6	2.4	e

Hémoglobine BG

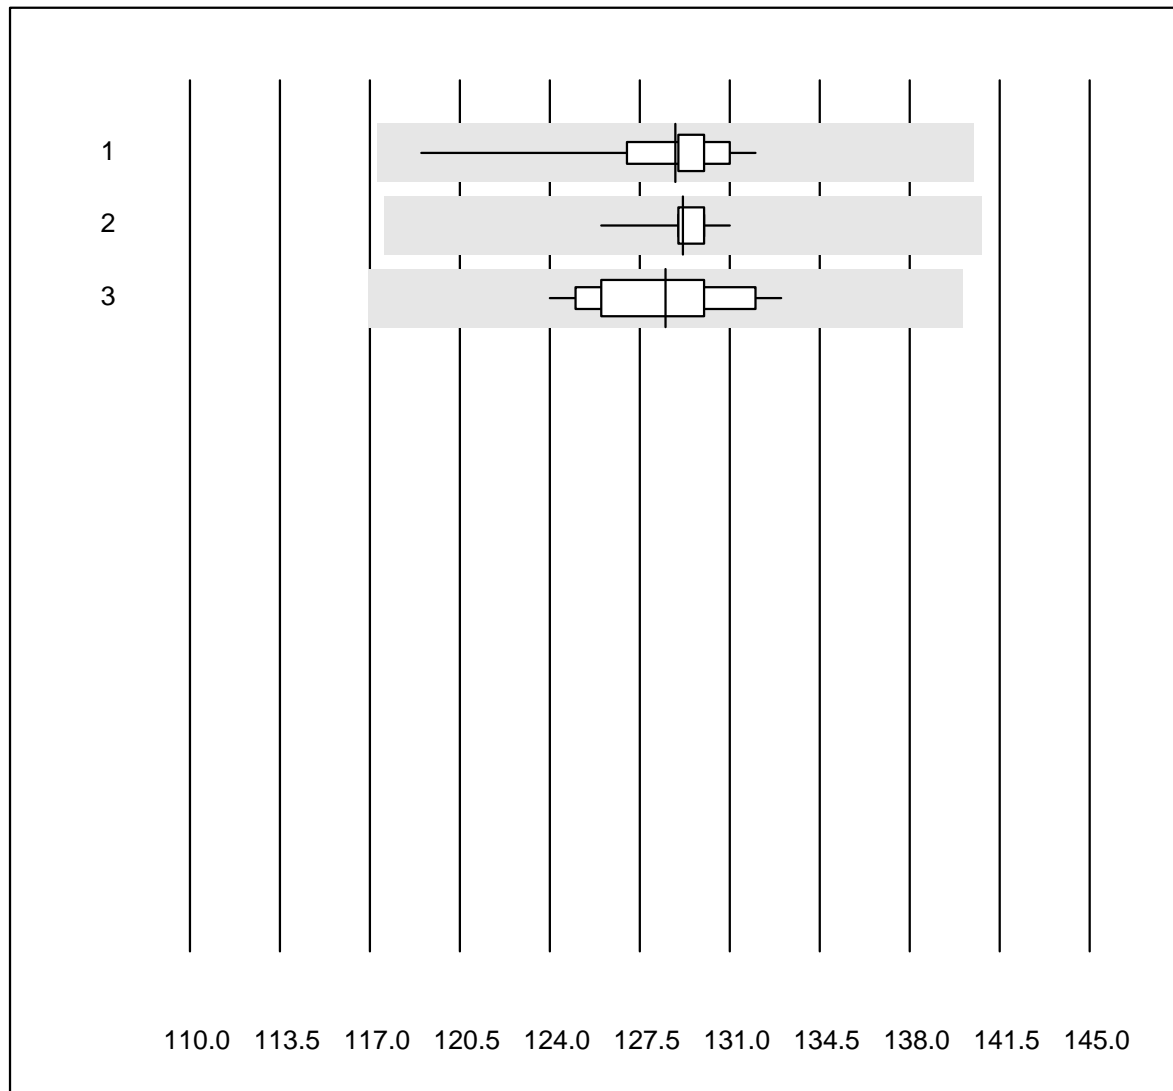


QUALAB Toleranz : 9 %

Hémoglobine BG (g/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL700/800	85	100.0	0.0	0.0	128.9	1.9	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	76	97.4	0.0	2.6	129.2	0.5	e
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	12	100.0	0.0	0.0	128.5	2.1	e

Potassium BG

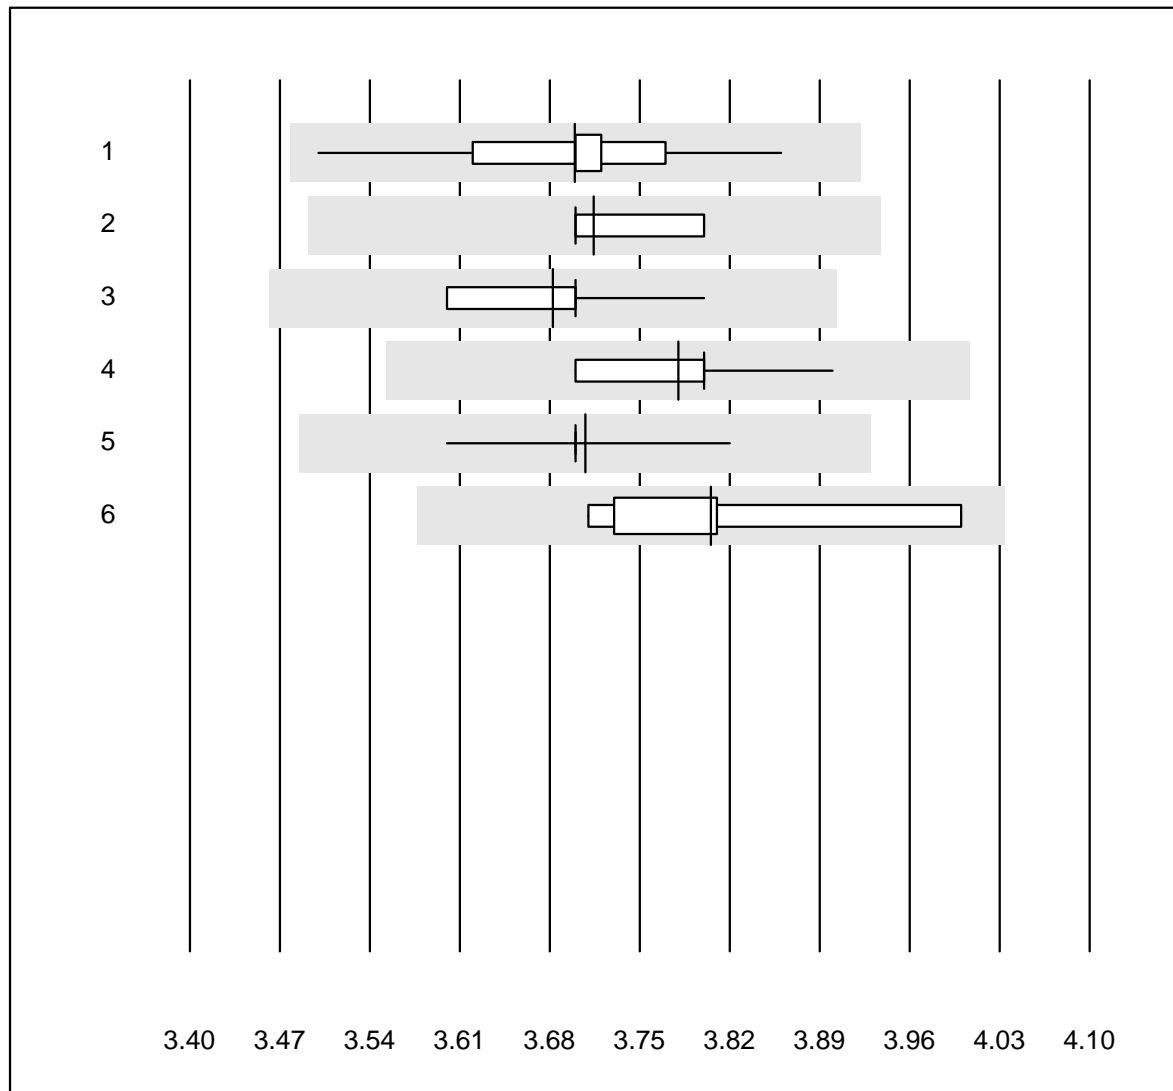


QUALAB Toleranz : 6 %

Potassium BG (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas b 123	19	100.0	0.0	0.0	3.7	1.9	e
2	iStat	21	100.0	0.0	0.0	3.7	1.0	e
3	EPOC	40	100.0	0.0	0.0	3.7	1.4	e
4	ABL700/800	85	100.0	0.0	0.0	3.8	1.2	e
5	ABL90 FLEX / PLUS	80	100.0	0.0	0.0	3.7	0.9	e
6	ABL80 FLEX CO-OX / O	8	100.0	0.0	0.0	3.8	2.6	e*

Sodium BG

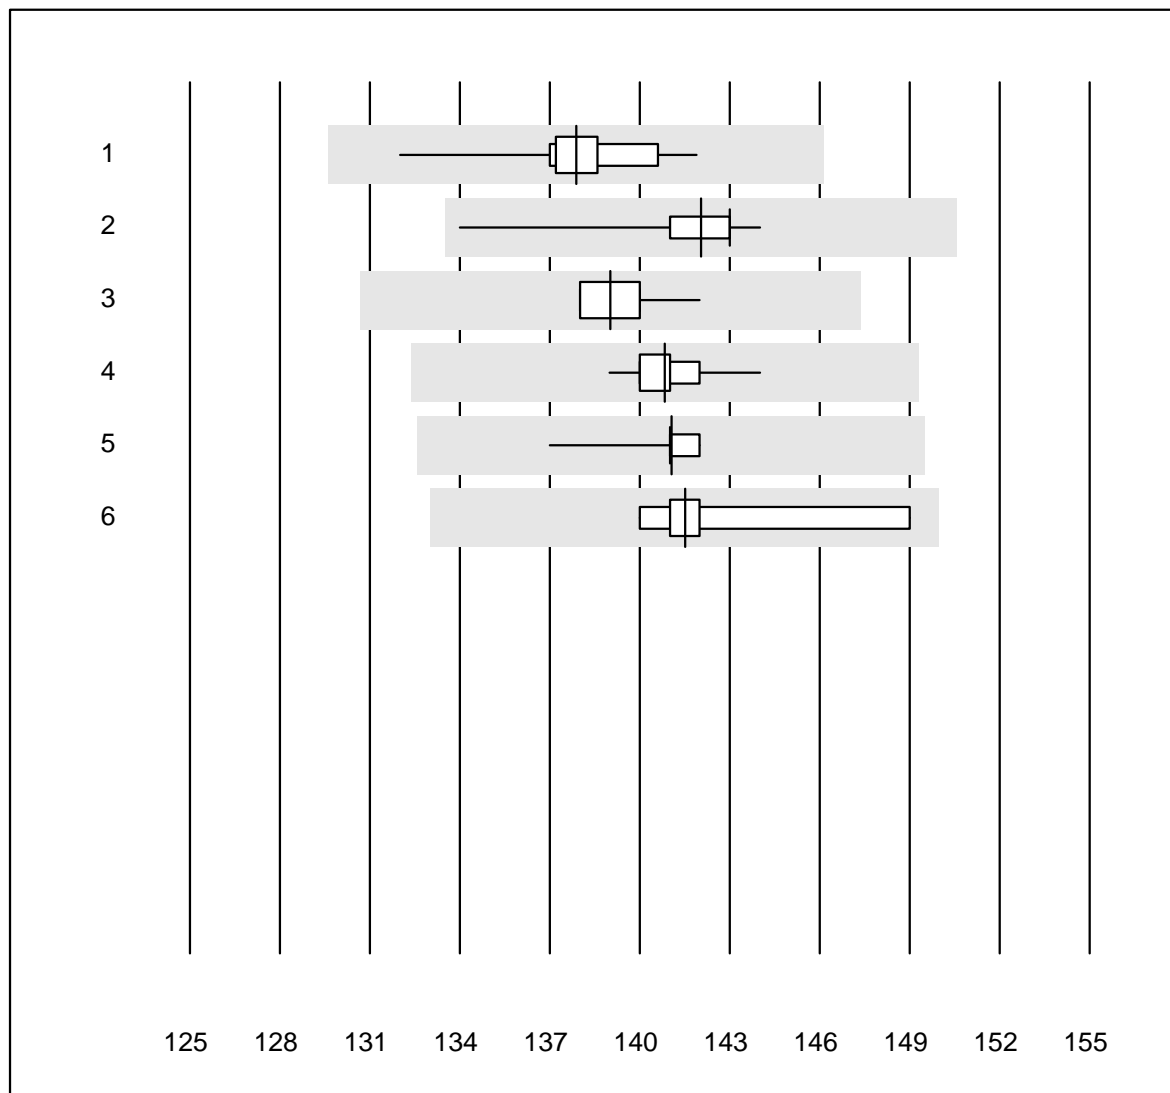


QUALAB Toleranz : 6 %

Sodium BG (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas b 123	19	100.0	0.0	0.0	137.9	1.4	e
2	iStat	21	100.0	0.0	0.0	142.0	1.8	e
3	EPOC	38	100.0	0.0	0.0	139.0	0.6	e
4	ABL700/800	83	100.0	0.0	0.0	140.8	0.7	e
5	ABL90 FLEX / PLUS	79	100.0	0.0	0.0	141.0	0.4	e
6	ABL80 FLEX CO-OX / O	8	100.0	0.0	0.0	141.5	2.2	e*

Chlorure-BG

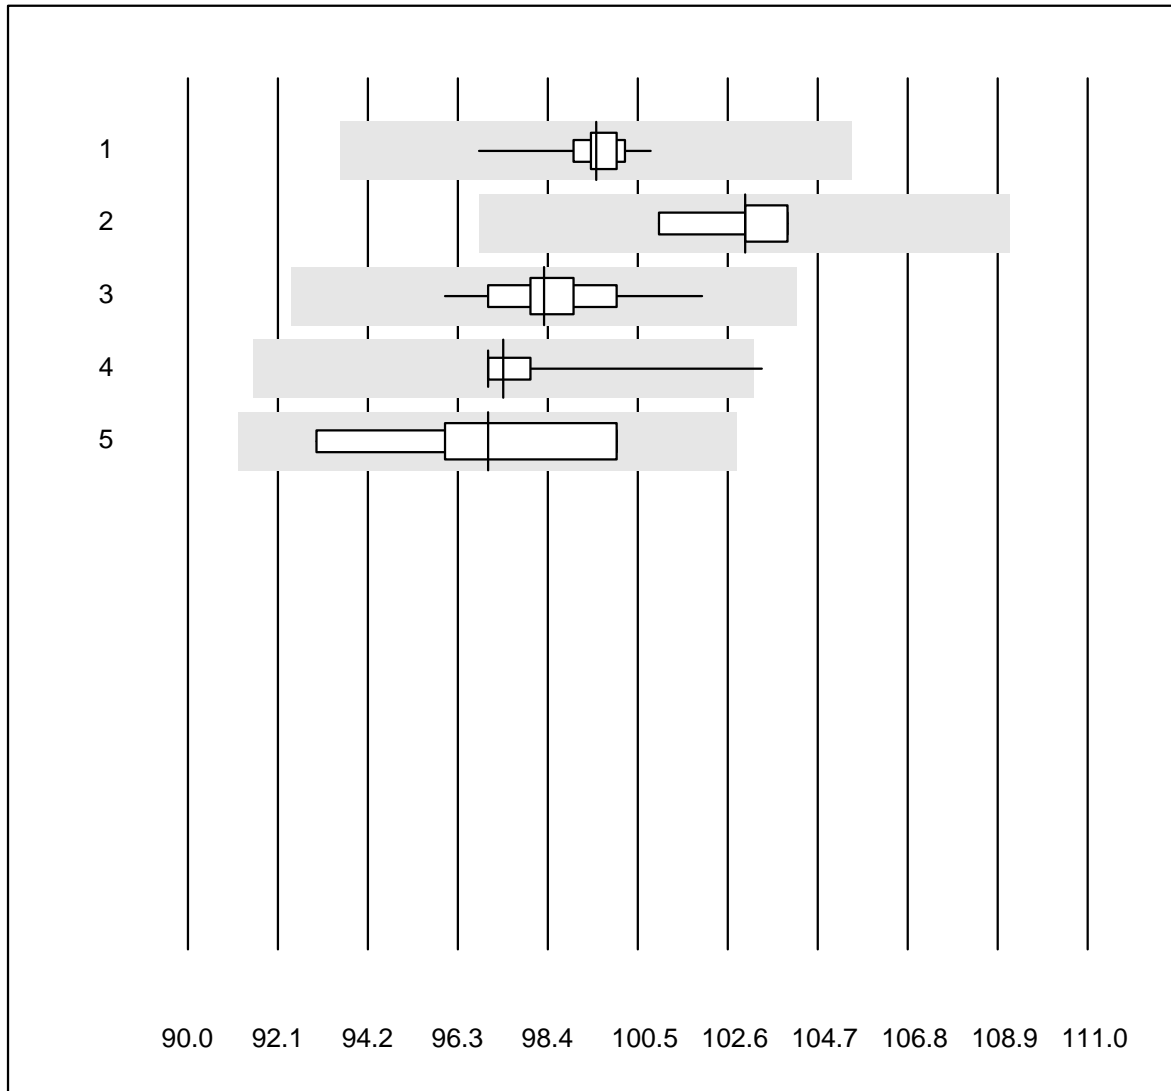


QUALAB Toleranz : 6 %

Chlorure-BG (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas b 123	11	100.0	0.0	0.0	99.5	1.0	e
2 EPOC	5	100.0	0.0	0.0	103.0	1.2	e
3 ABL700/800	78	100.0	0.0	0.0	98.3	1.3	e
4 ABL90 FLEX / PLUS	76	98.7	1.3	0.0	97.4	0.9	e
5 ABL80 FLEX CO-OX / O	5	100.0	0.0	0.0	97.0	3.0	e*

Calcium-BG

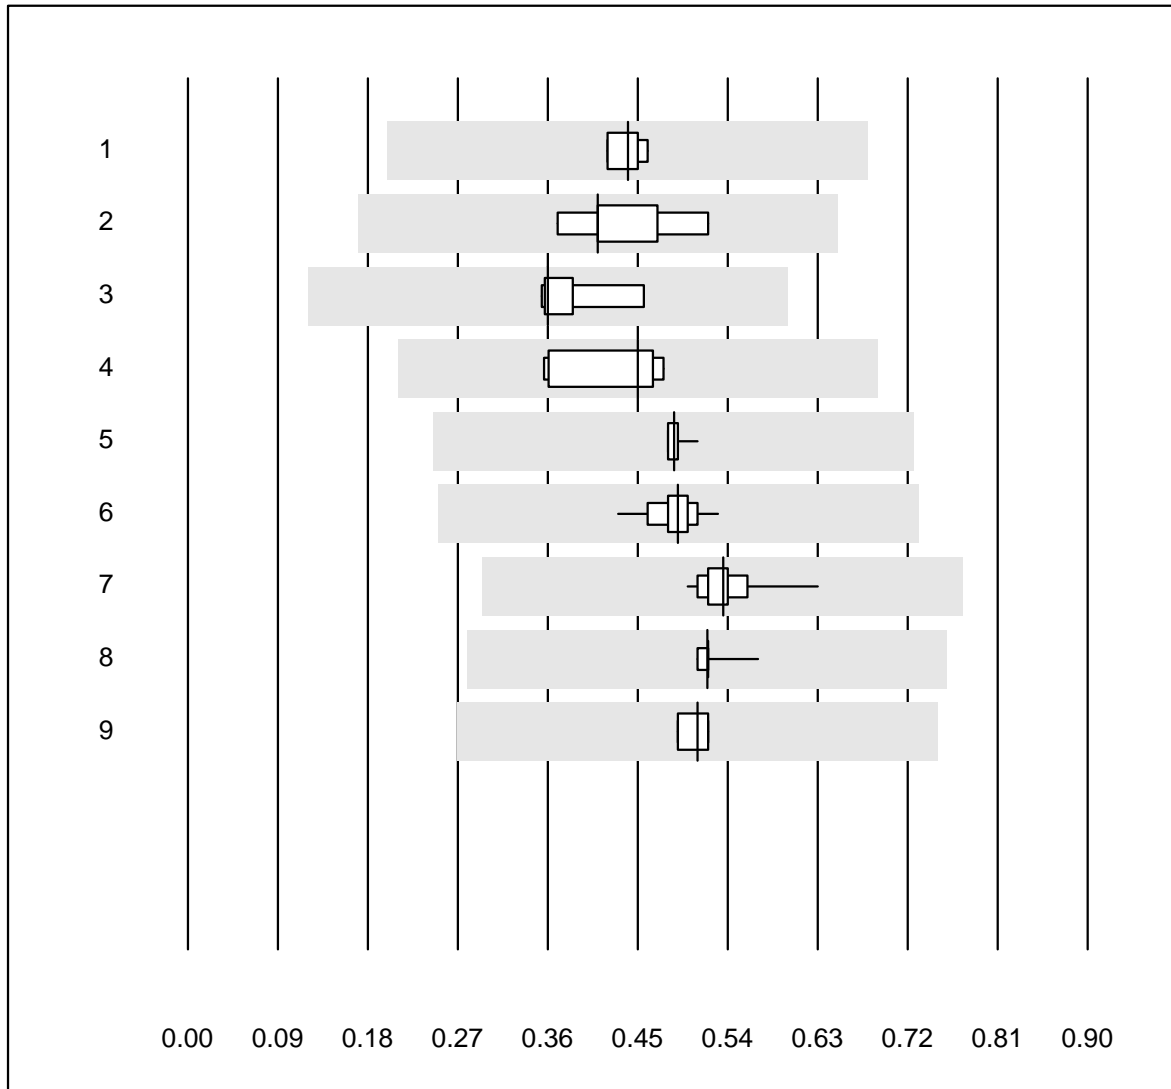


Tolérance MQ : 12 %
(< 2.00: +/- 0.24 mmol/l)

Calcium-BG (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 GEM	4	100.0	0.0	0.0	0.44	4.1	e*
2 ABL80 FLEX	5	100.0	0.0	0.0	0.41	13.5	e*
3 Cobas b123	9	100.0	0.0	0.0	0.36	8.7	e*
4 Cobas	7	100.0	0.0	0.0	0.45	12.1	e*
5 iStat	11	90.9	0.0	9.1	0.49	2.0	e
6 EPOC	36	100.0	0.0	0.0	0.49	4.2	e
7 ABL700/800	85	100.0	0.0	0.0	0.54	3.7	e
8 ABL90 FLEX / PLUS	78	100.0	0.0	0.0	0.52	1.5	e
9 ABL80 FLEX CO-OX / O	7	100.0	0.0	0.0	0.51	2.7	e

FHHb

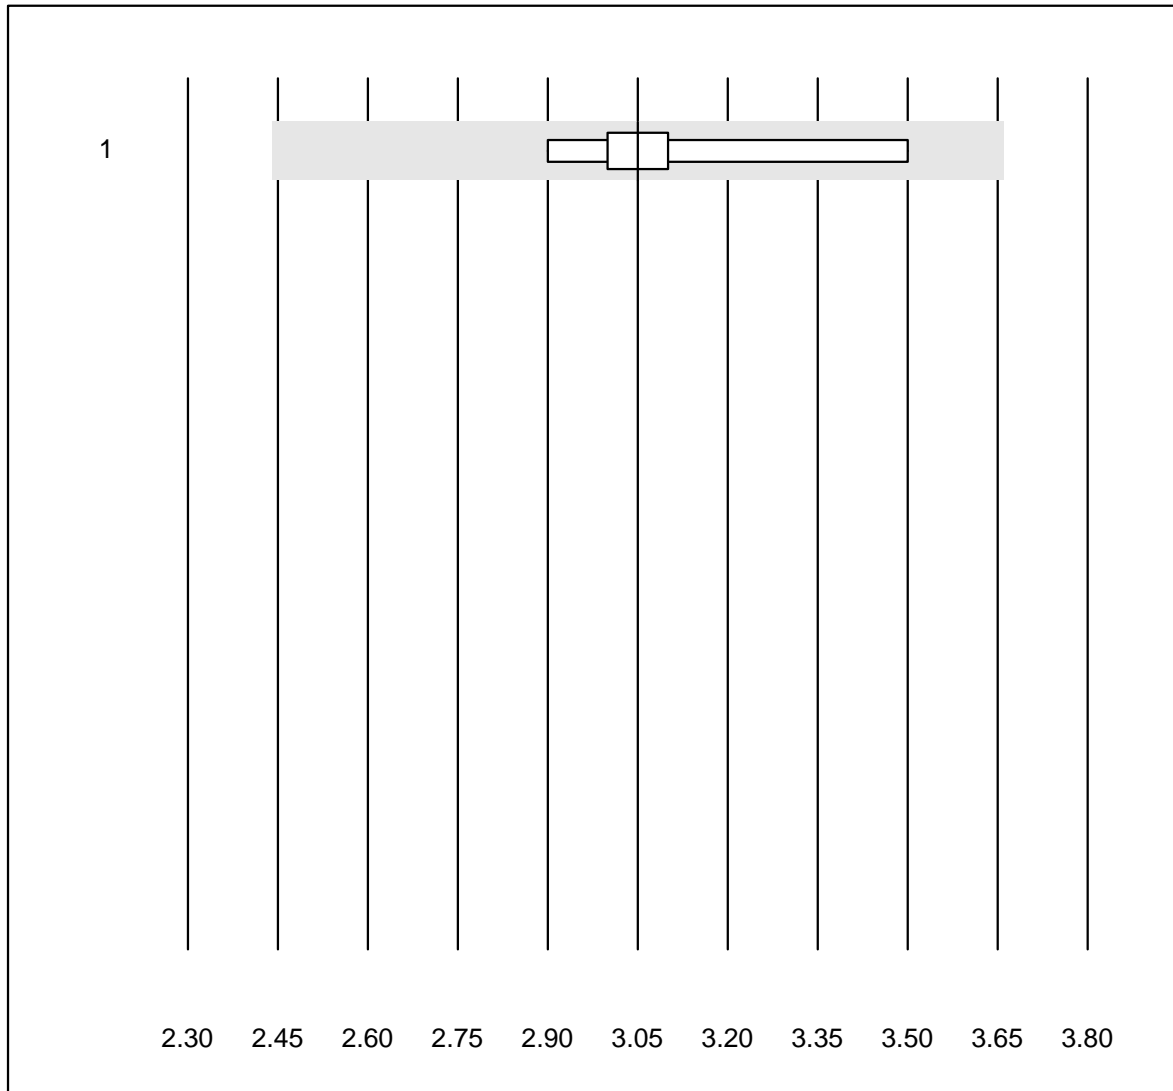


Tolérance MQ : 20 %

FHHb (%)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL80 FLEX CO-OX / O	6	100.0	0.0	0.0	3.050	6.8	e*

Lactate-BG

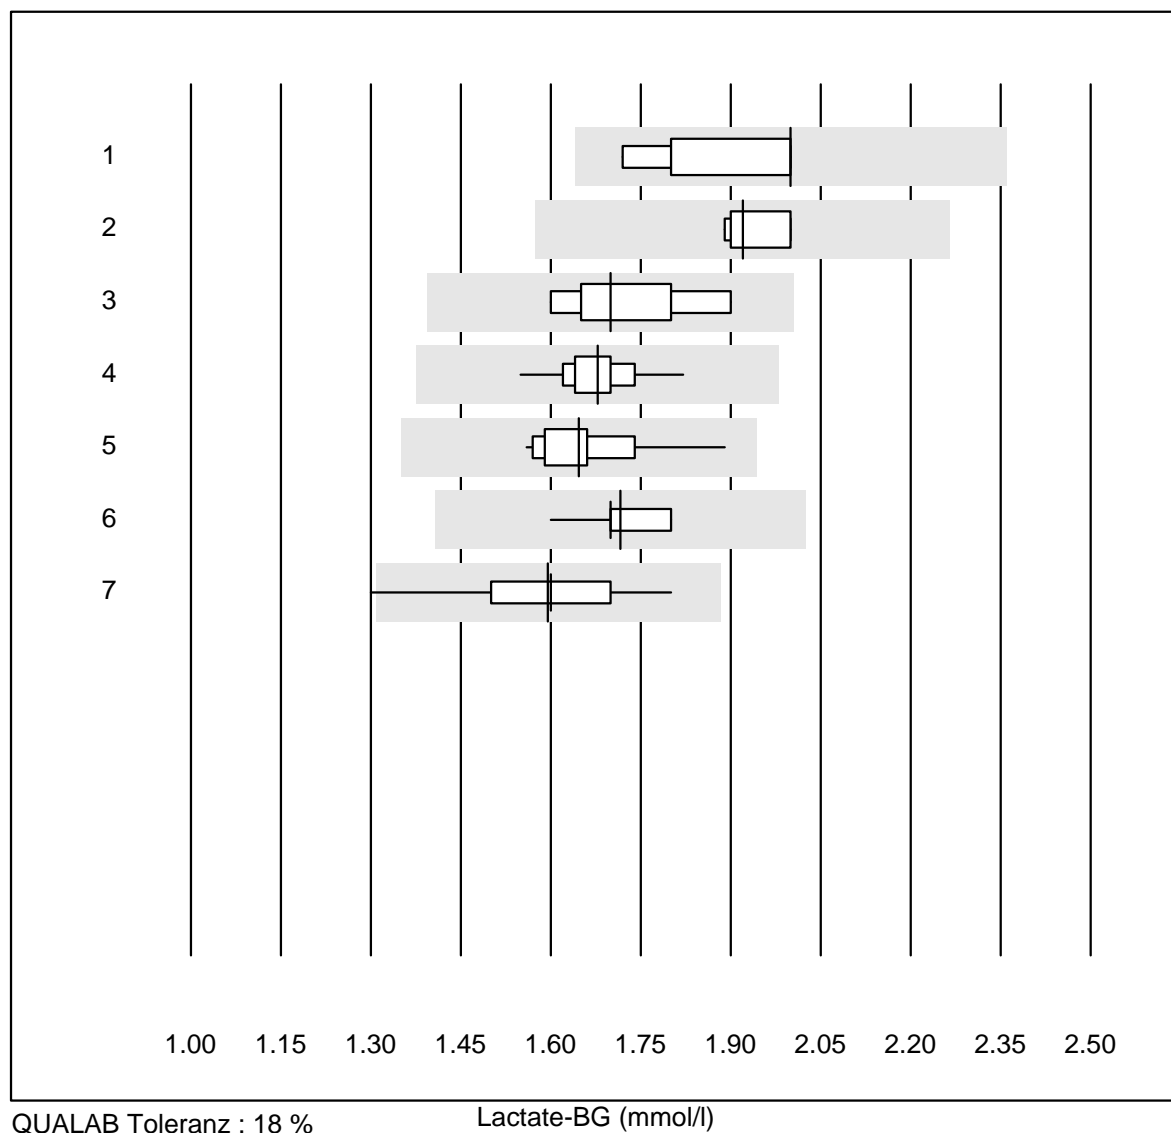

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas b123	7	100.0	0.0	0.0	2.00	6.0	e*
2	Cobas	6	100.0	0.0	0.0	1.92	2.6	e
3	IL	5	100.0	0.0	0.0	1.70	7.0	e*
4	EPOC	38	100.0	0.0	0.0	1.68	3.2	e
5	iStat	14	100.0	0.0	0.0	1.65	5.2	e
6	ABL700/800	86	100.0	0.0	0.0	1.72	3.1	e
7	ABL90 FLEX / PLUS	80	98.7	1.3	0.0	1.60	4.5	e

sO2 OR

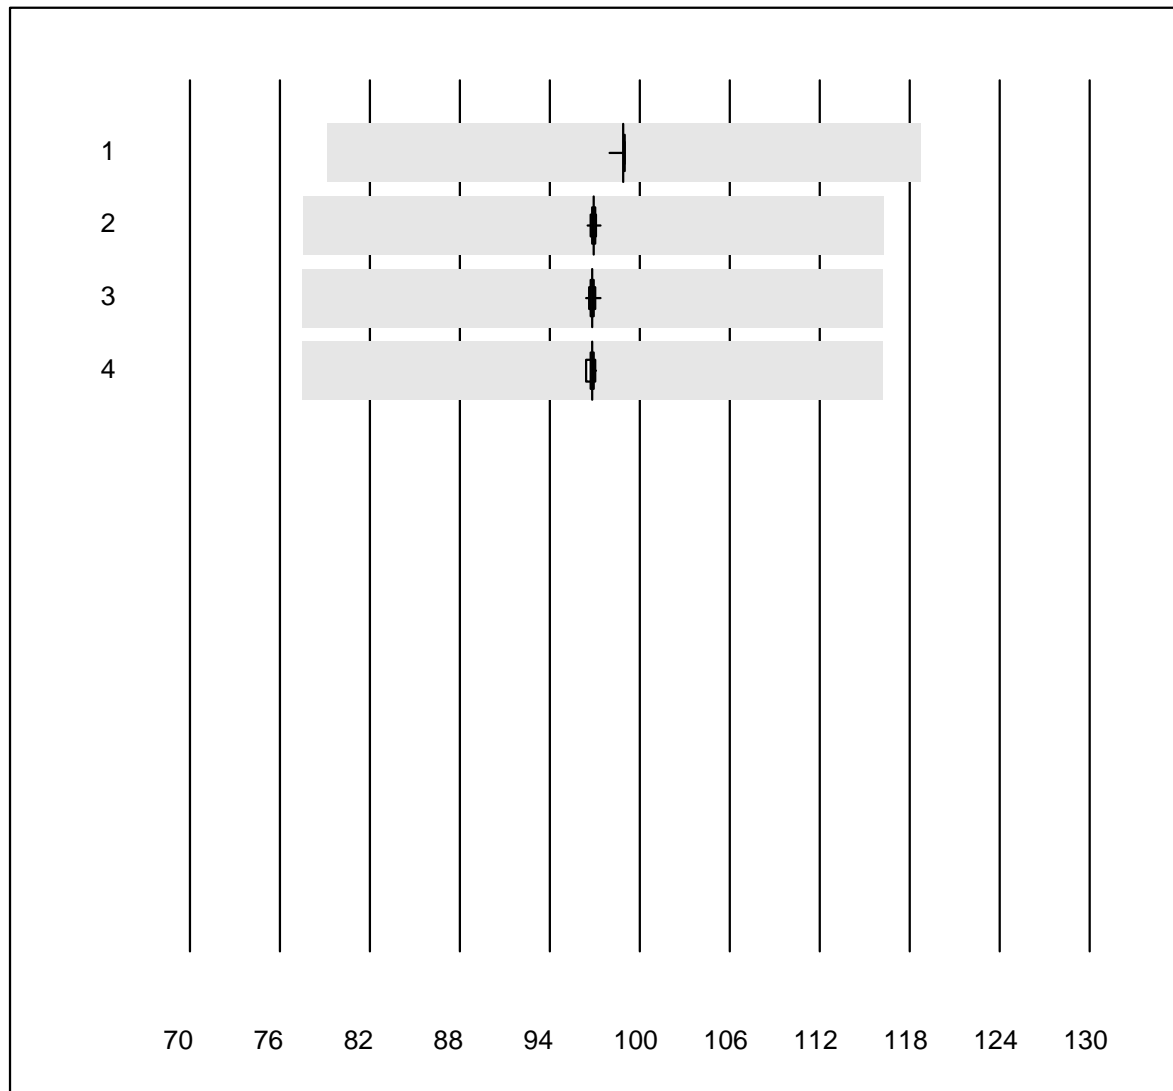


Tolérance MQ : 20 %

sO2 OR (%)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 iStat	11	100.0	0.0	0.0	98.909	0.3	e
2 ABL700/800	68	100.0	0.0	0.0	96.925	0.2	e
3 ABL90 FLEX / PLUS	68	100.0	0.0	0.0	96.806	0.2	e
4 ABL80 FLEX CO-OX / O	10	100.0	0.0	0.0	96.810	0.2	e

FO2Hb OR

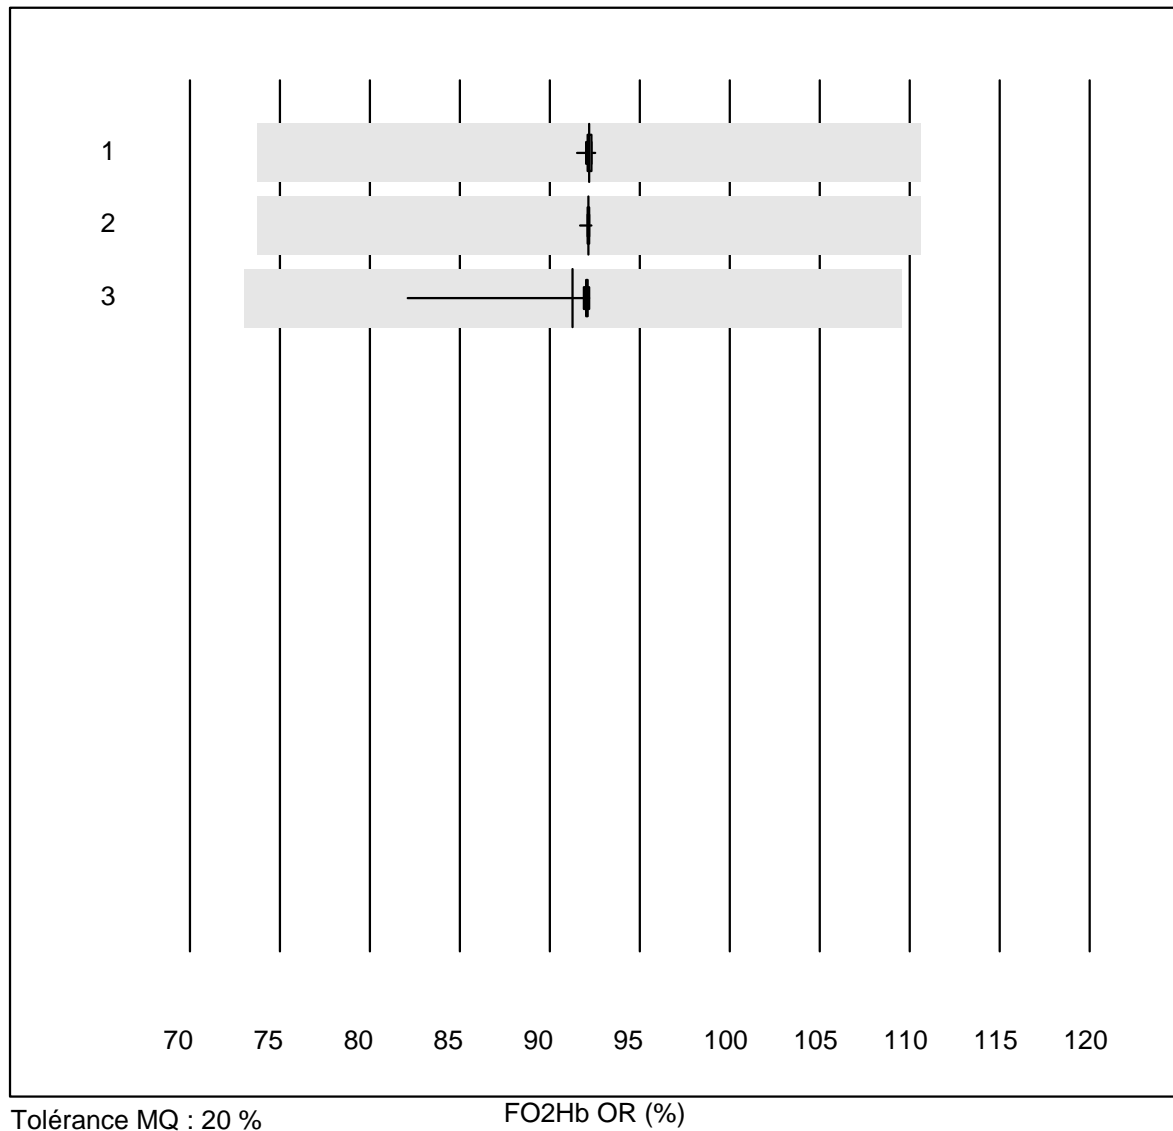


Tolérance MQ : 20 %

FO2Hb OR (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL700/800	67	100.0	0.0	0.0	92.190	0.2	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	68	98.5	0.0	1.5	92.157	0.1	e
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	12	100.0	0.0	0.0	91.267	3.2	e

FCOHb OR

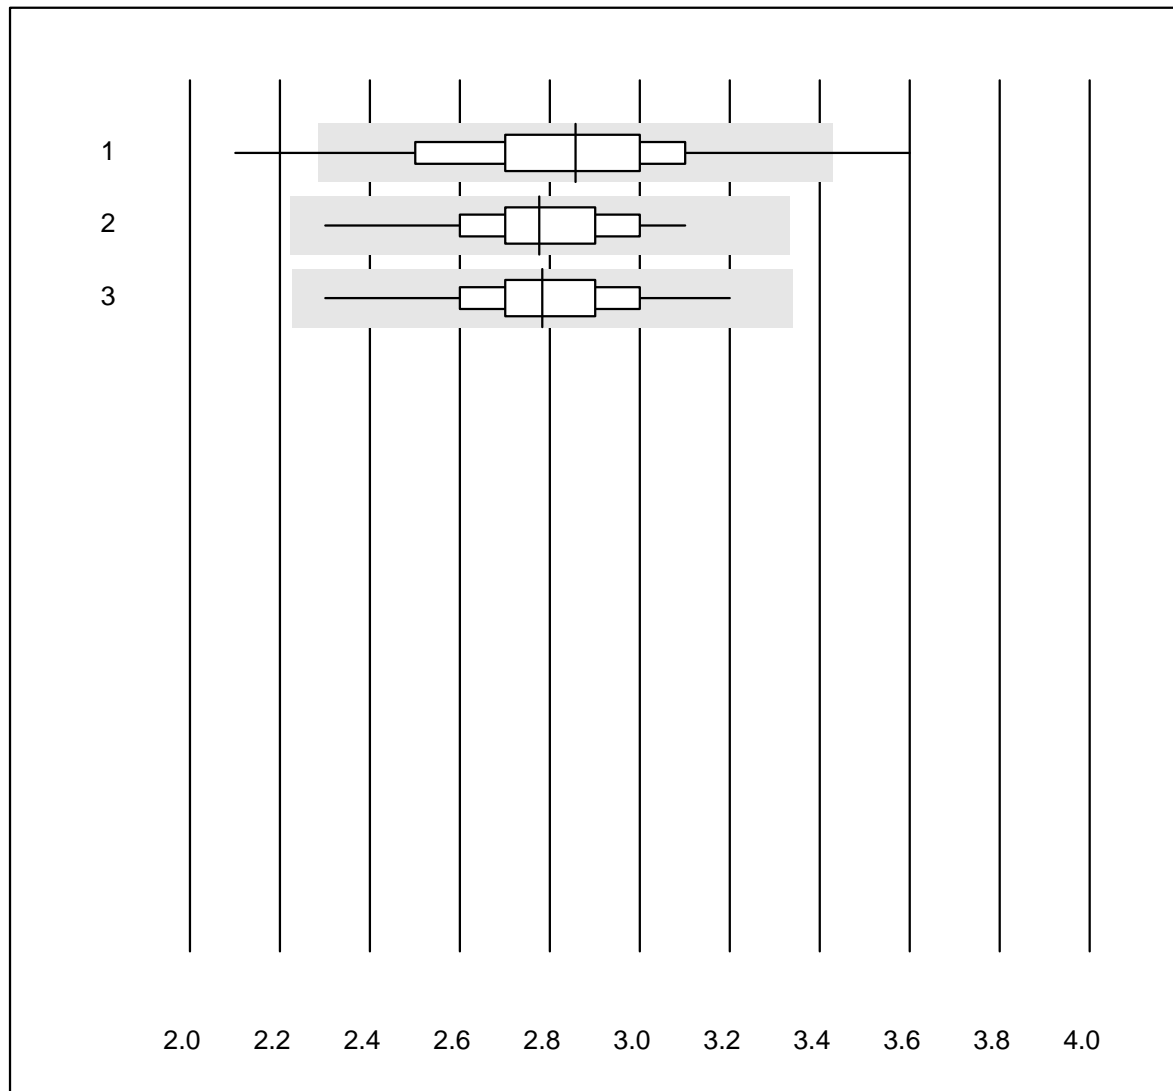


Tolérance MQ : 20 %

FCOHb OR (%)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL700/800	69	95.7	4.3	0.0	2.857	9.6	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	67	98.5	0.0	1.5	2.777	6.0	e
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	12	100.0	0.0	0.0	2.783	7.9	e

FMetHb OR

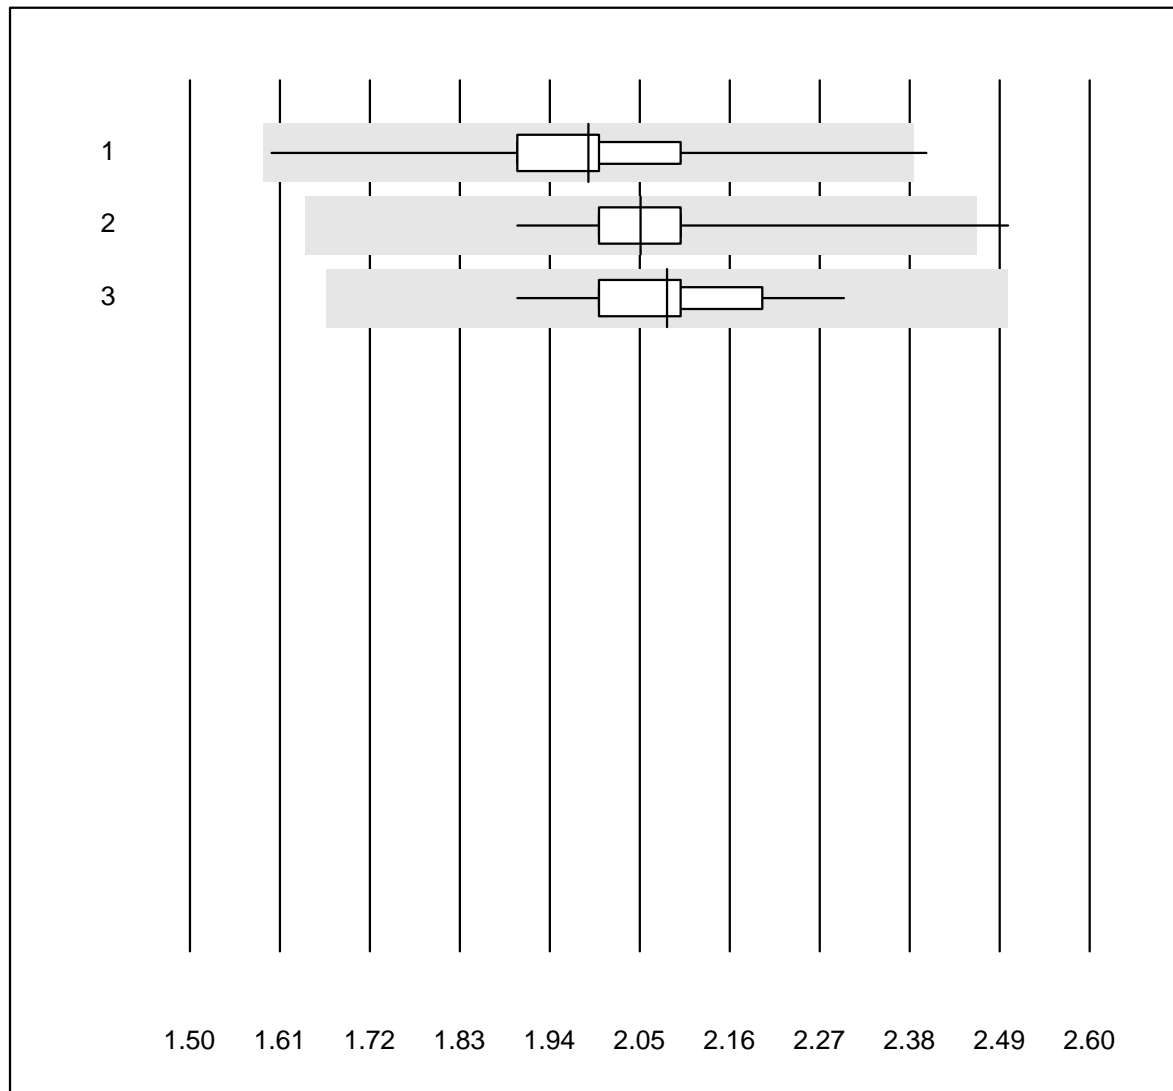


Tolérance MQ : 20 %

FMetHb OR (%)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 ABL700/800	72	93.0	5.6	1.4	1.987	7.1	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	67	98.5	1.5	0.0	2.051	4.4	e
3 ABL80 FLEX CO-OX / O	12	100.0	0.0	0.0	2.083	4.9	e

FHbF OR

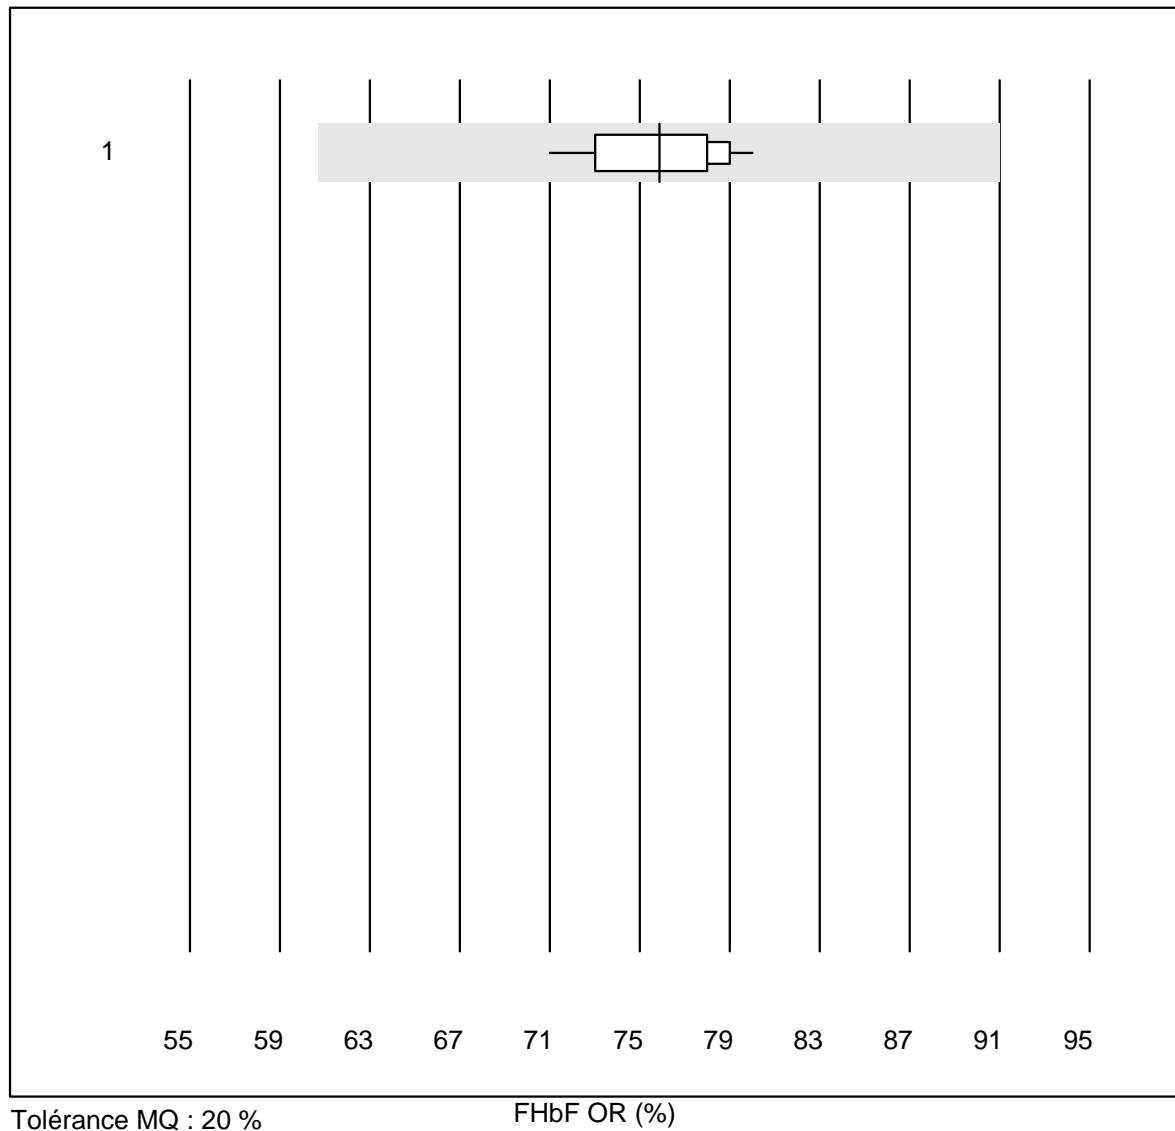

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL90 FLEX / PLUS	16	100.0	0.0	0.0	75.875	3.6	e

Bilirubin OR

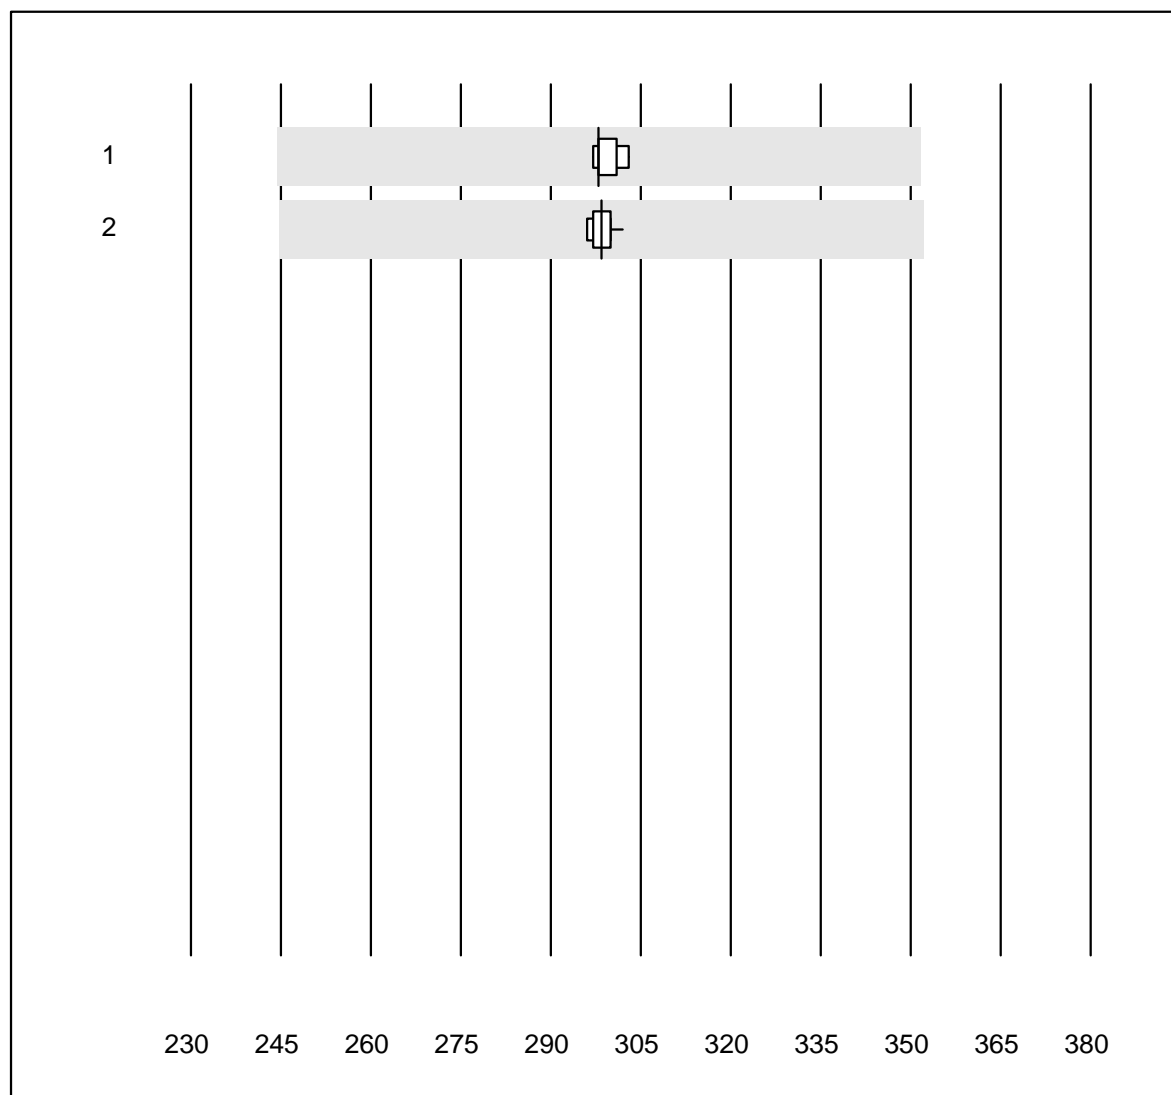


QUALAB Toleranz : 18 %

Bilirubin OR (µmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	ABL700/800	5	100.0	0.0	0.0	298.0	0.8	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	26	100.0	0.0	0.0	298.4	0.5	e

Troponine I

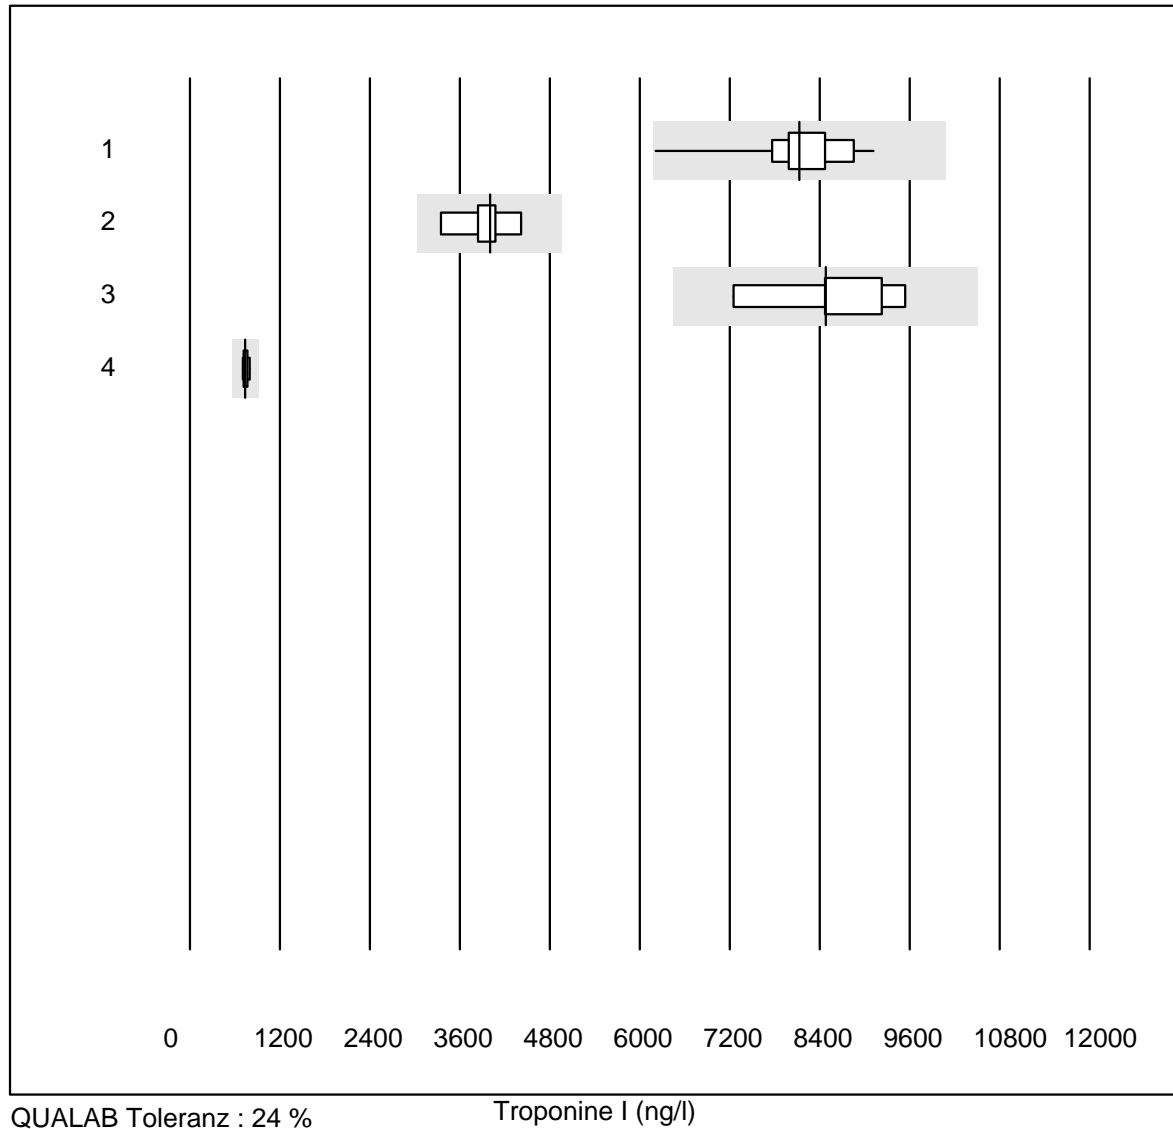


QUALAB Toleranz : 24 %

Troponine I (ng/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Vidas	13	100.0	0.0	0.0	8131.5	8.5	e
2 Architect High Sensi	9	100.0	0.0	0.0	3999.0	7.5	e
3 Autres méthodes	6	83.3	0.0	16.7	8476.5	10.3	e*
4 AQT 90 FLEX	5	100.0	0.0	0.0	740.0	4.9	e

Troponine T

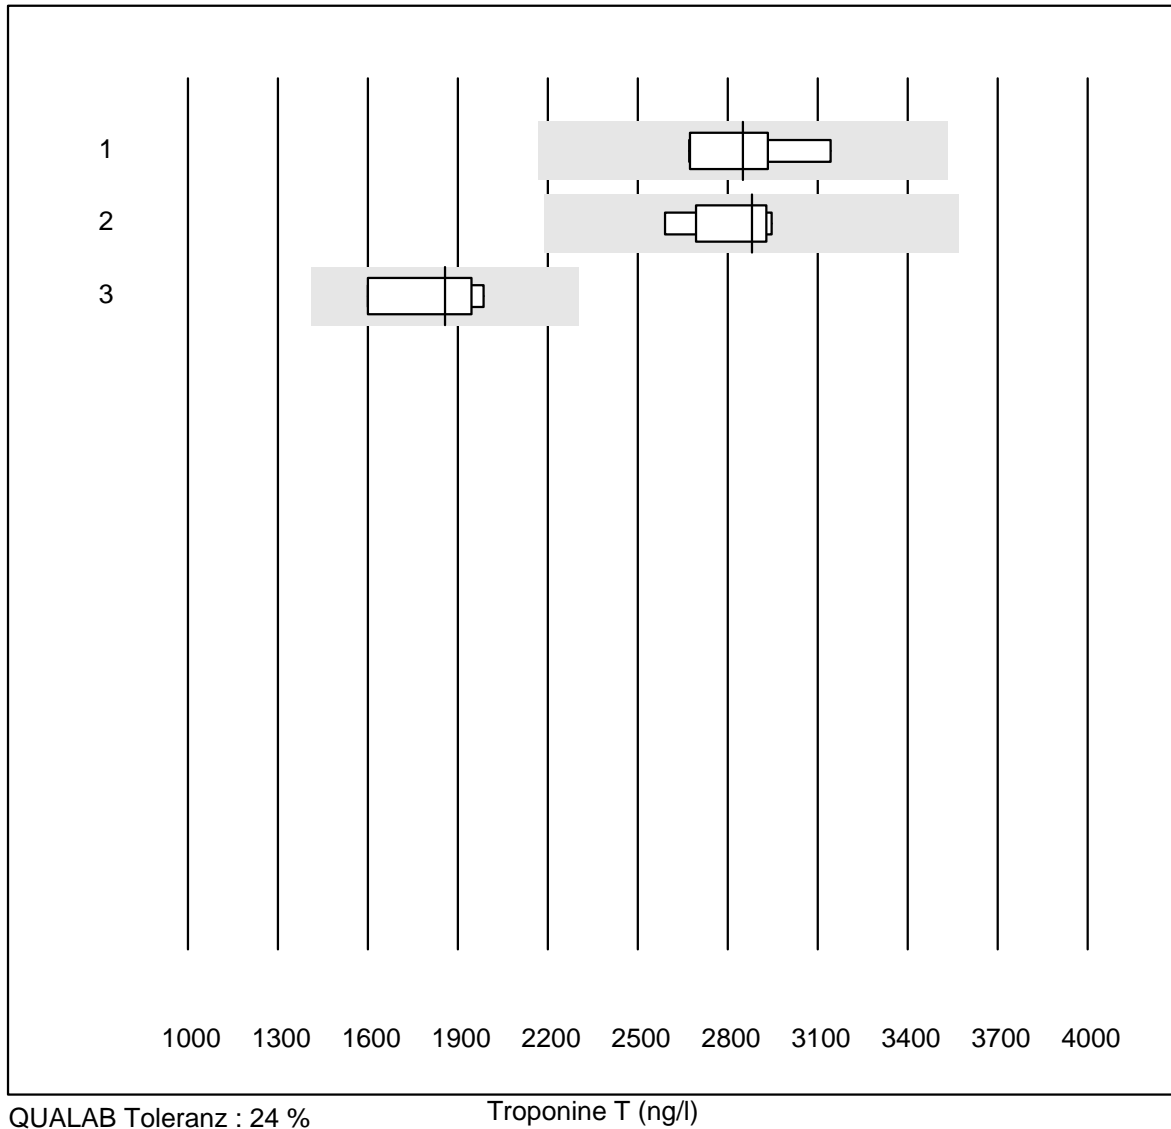

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas hs	5	100.0	0.0	0.0	2850.00	6.9	e*
2 Cobas hs STAT	8	100.0	0.0	0.0	2880.00	4.6	e
3 Cobas E / Elecsys	4	100.0	0.0	0.0	1857.00	9.7	e*

Myoglobine

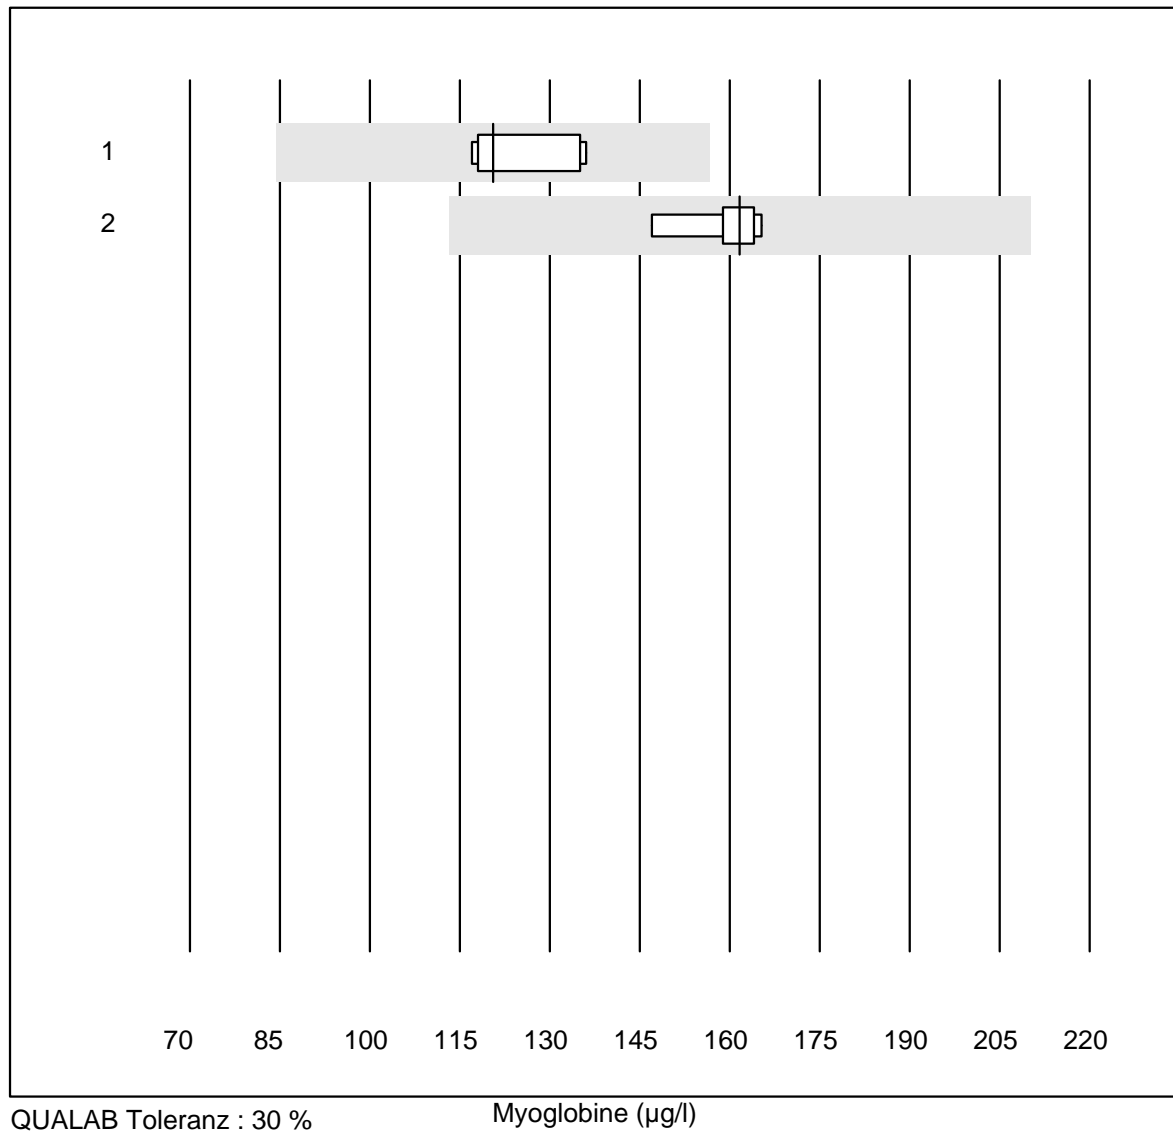


QUALAB Toleranz : 30 %

Myoglobine (µg/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	6	100.0	0.0	0.0	120.6	6.9	e
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	161.7	4.6	e

masse CK-MB

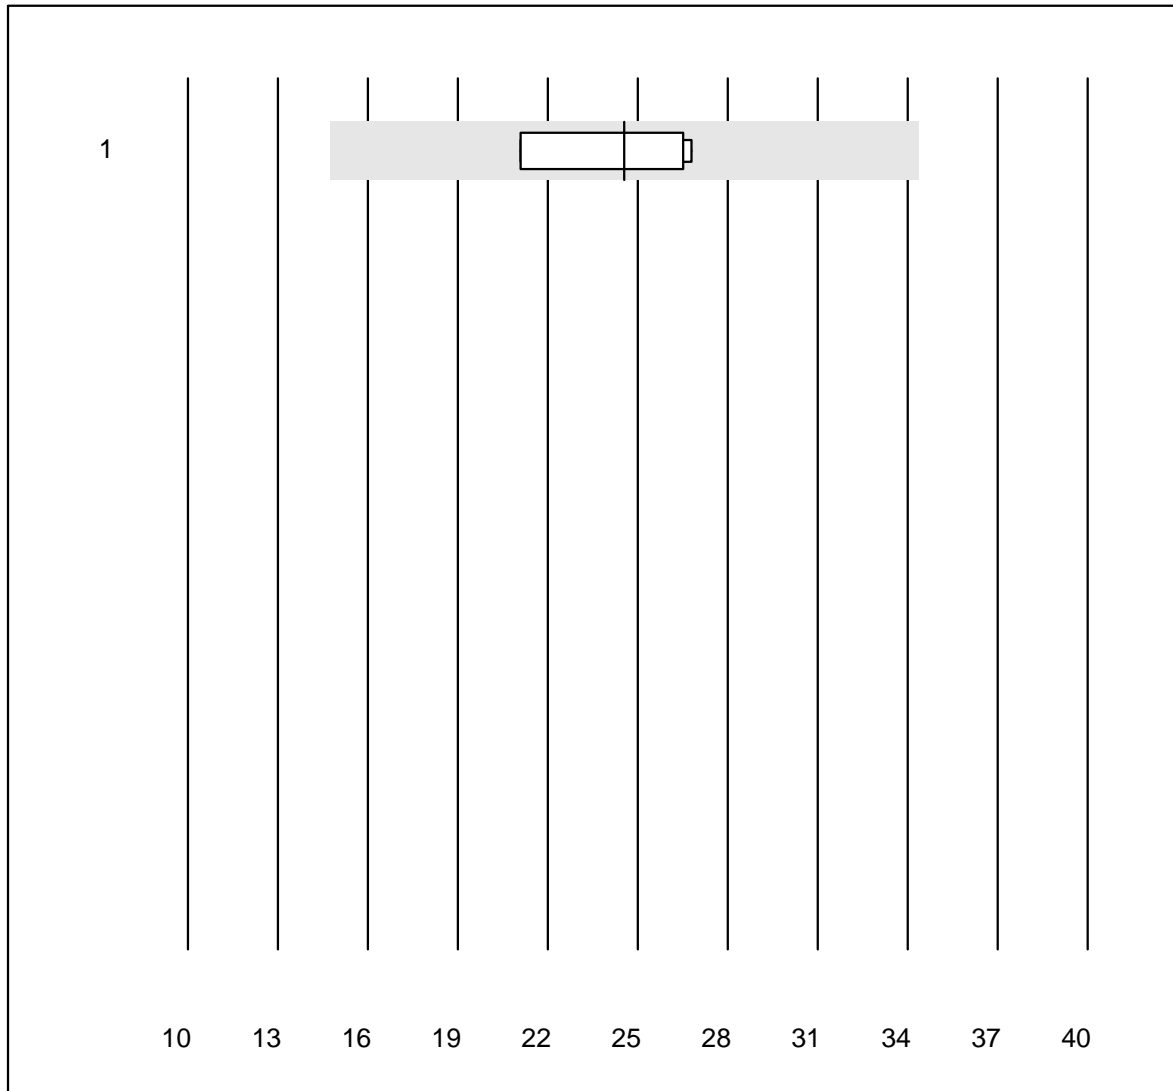


Tolérance MQ : 40 %

masse CK-MB (µg/l)


Nr.	Methode	Total	% Efulft	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	4	100.0	0.0	0.0	24.6	11.7	e*

NT-proBNP

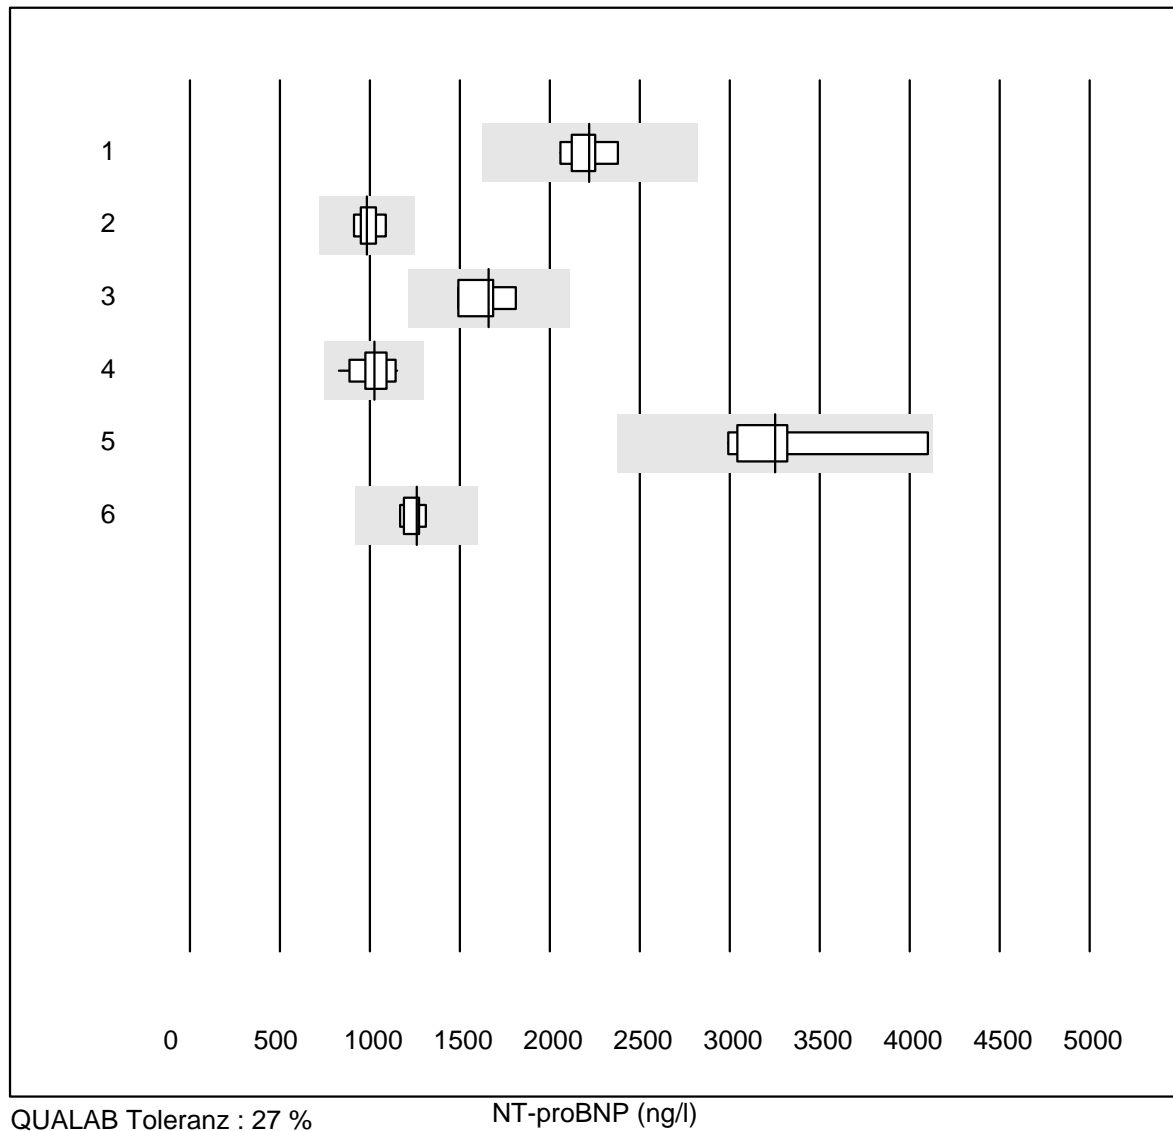

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	AQT 90 FLEX	6	100.0	0.0	0.0	2220.0	5.0	e
2	VIDAS	9	100.0	0.0	0.0	983.0	5.8	e
3	Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	1660.0	8.0	e*
4	Cobas E / Elecsys	16	100.0	0.0	0.0	1024.5	9.3	e
5	Immulite	5	100.0	0.0	0.0	3250.0	13.4	a
6	Architect	6	100.0	0.0	0.0	1261.2	4.4	e

TSH

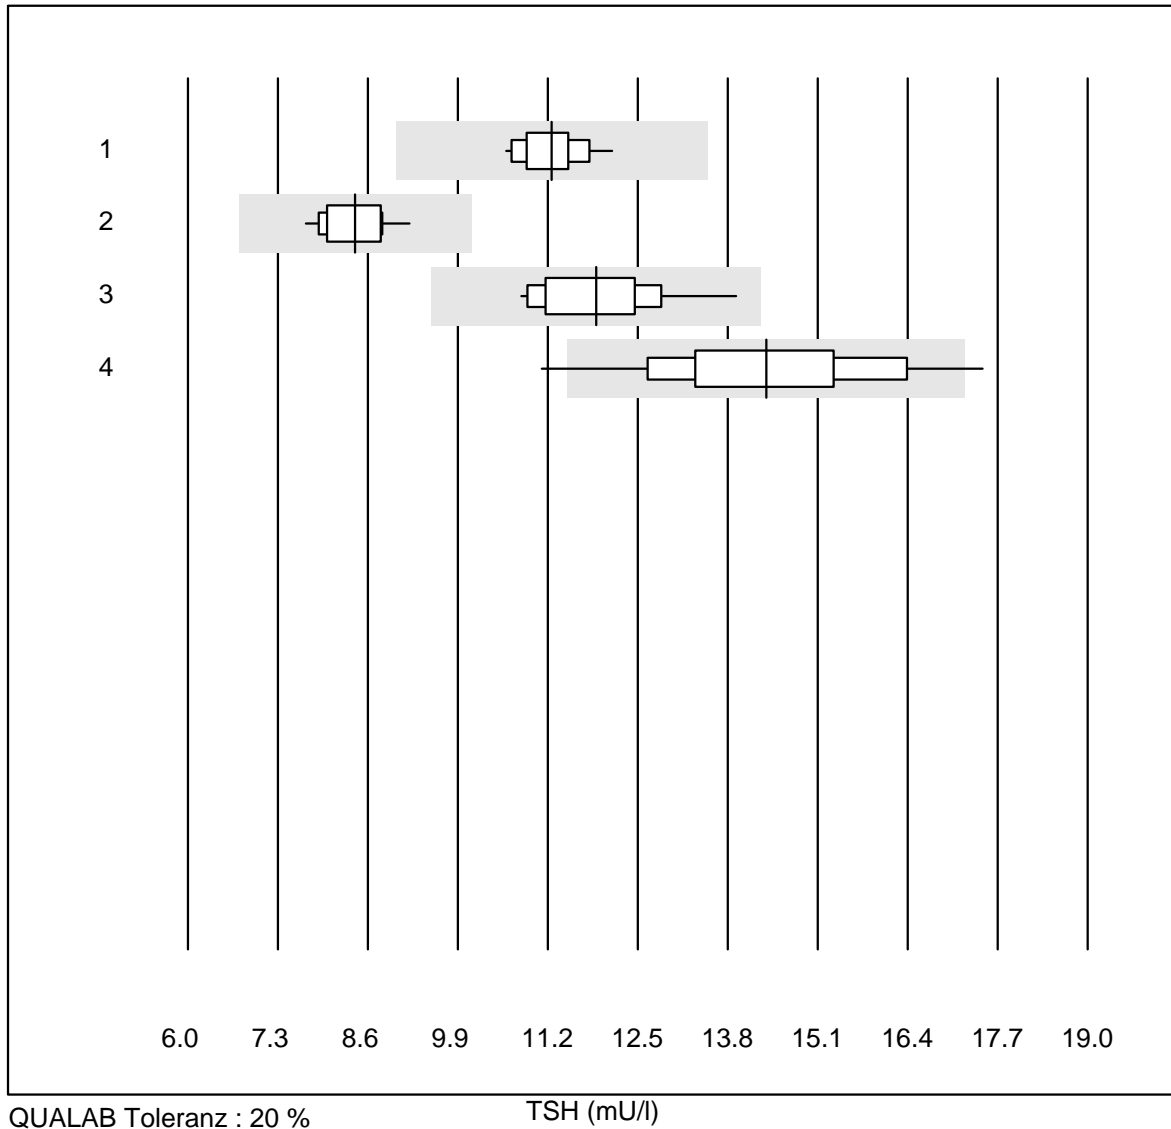


QUALAB Toleranz : 20 %

TSH (mU/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	16	100.0	0.0	0.0	11.25	3.8	e
2	Architect	11	100.0	0.0	0.0	8.42	5.4	e
3	VIDAS	16	100.0	0.0	0.0	11.90	7.3	e
4	AFIAS	38	92.1	7.9	0.0	14.36	10.6	e

T3

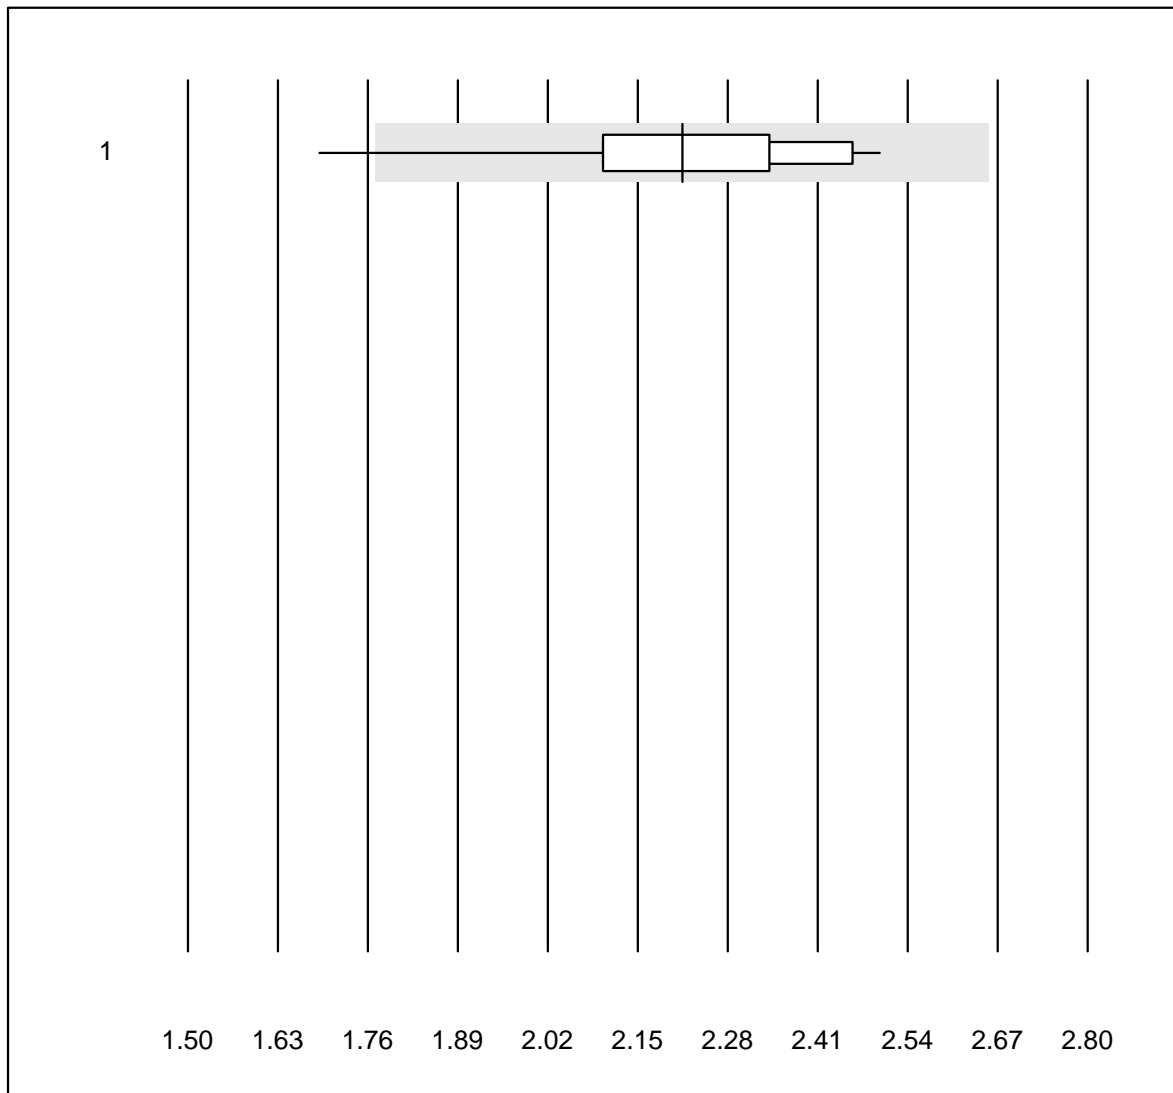


Tolérance MQ : 20 %

T3 (nmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 AFIAS	12	91.7	8.3	0.0	2.2	9.5	e*

T4

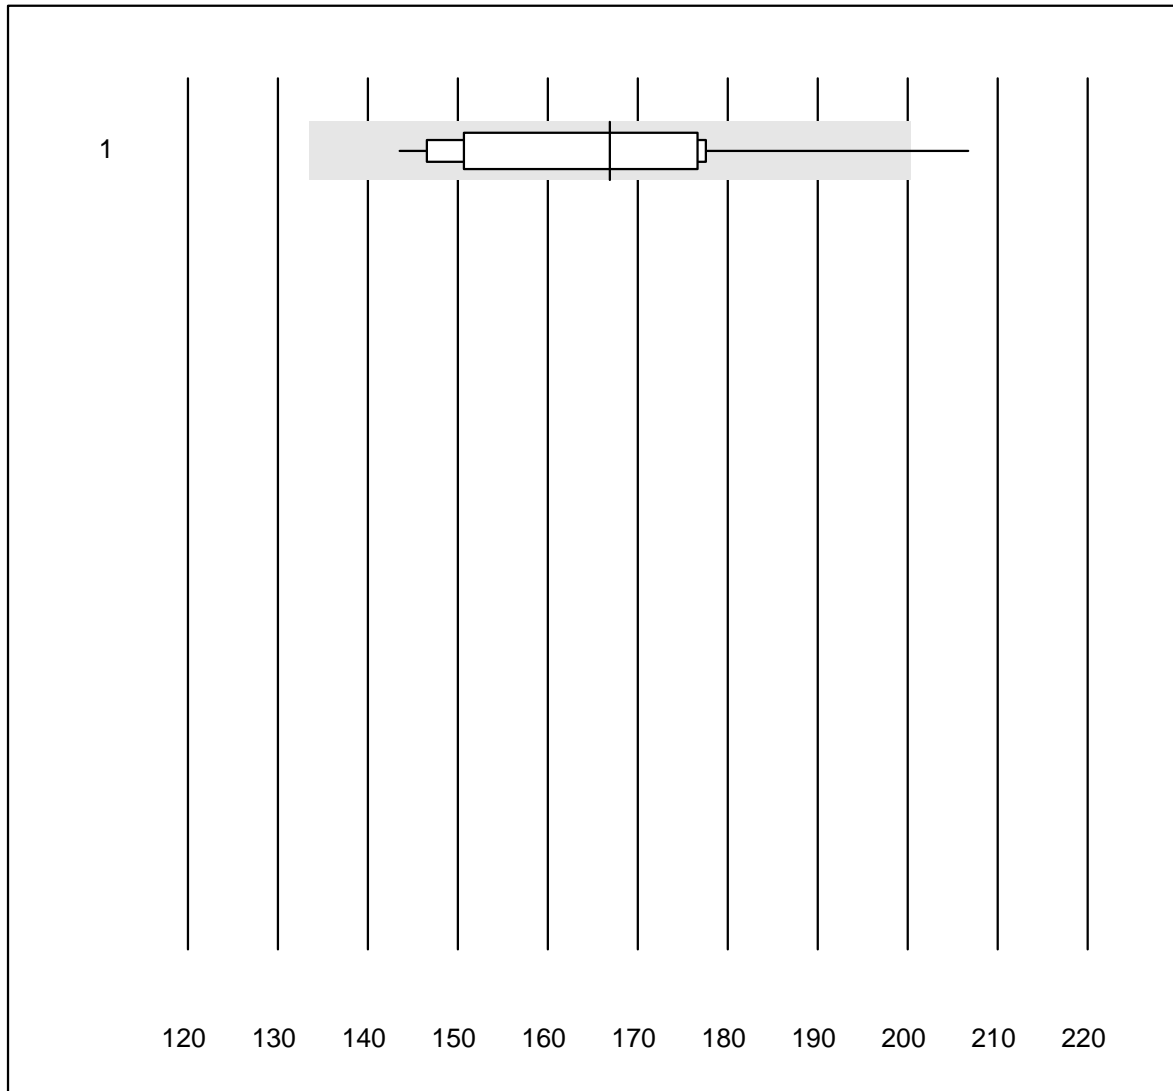


Tolérance MQ : 20 %

T4 (nmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 AFIAS	12	83.4	8.3	8.3	167	11.0	e*


FT3

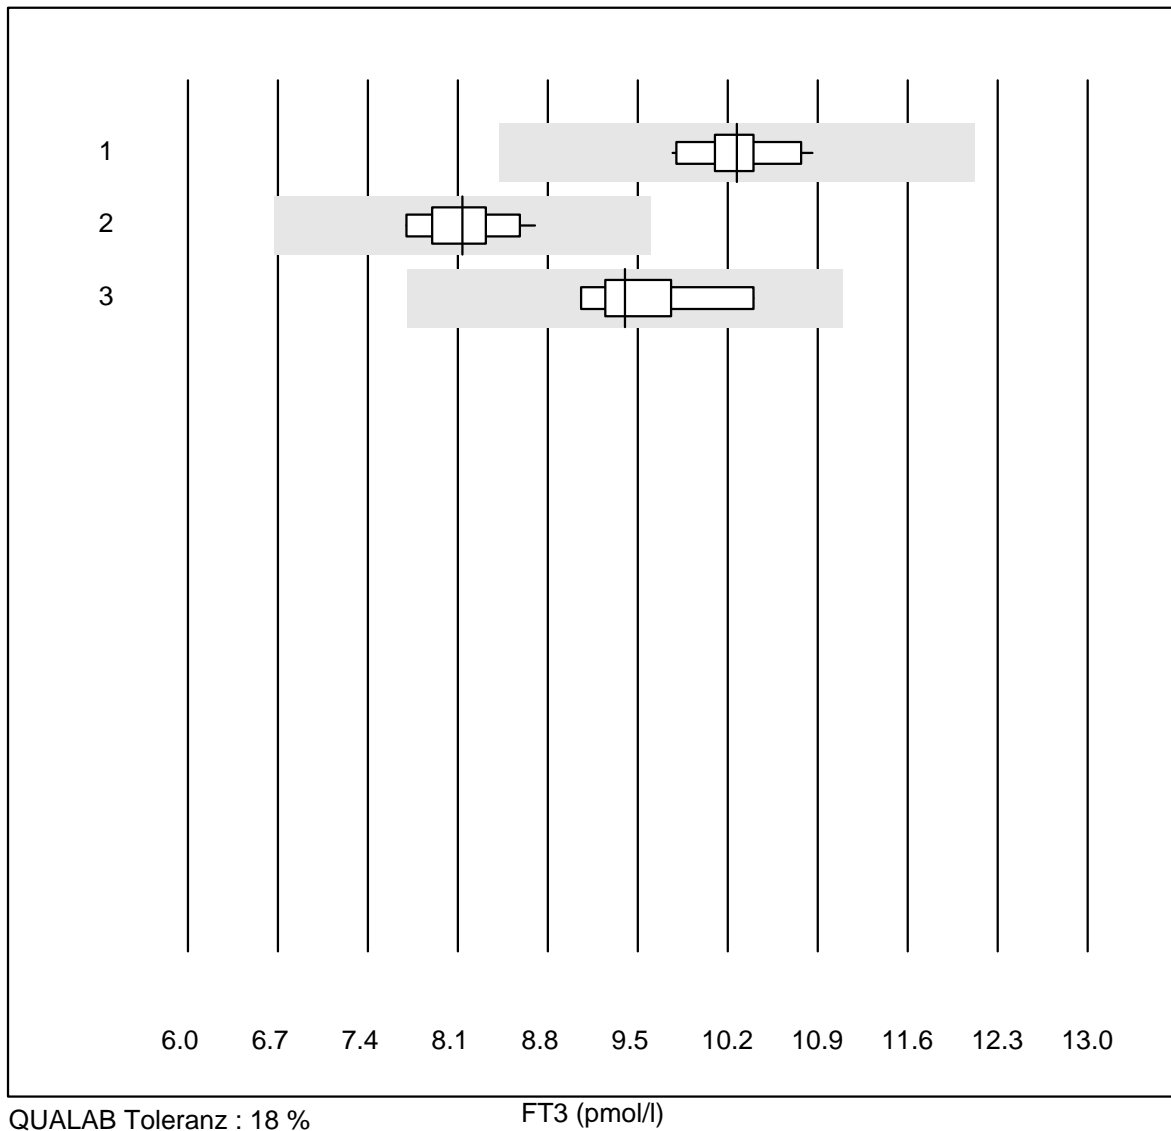

QUALAB Toleranz : 18 %

FT3 (pmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	14	100.0	0.0	0.0	10.3	3.1	e
2 Architect	10	100.0	0.0	0.0	8.1	4.0	e
3 VIDAS	7	100.0	0.0	0.0	9.4	4.6	e

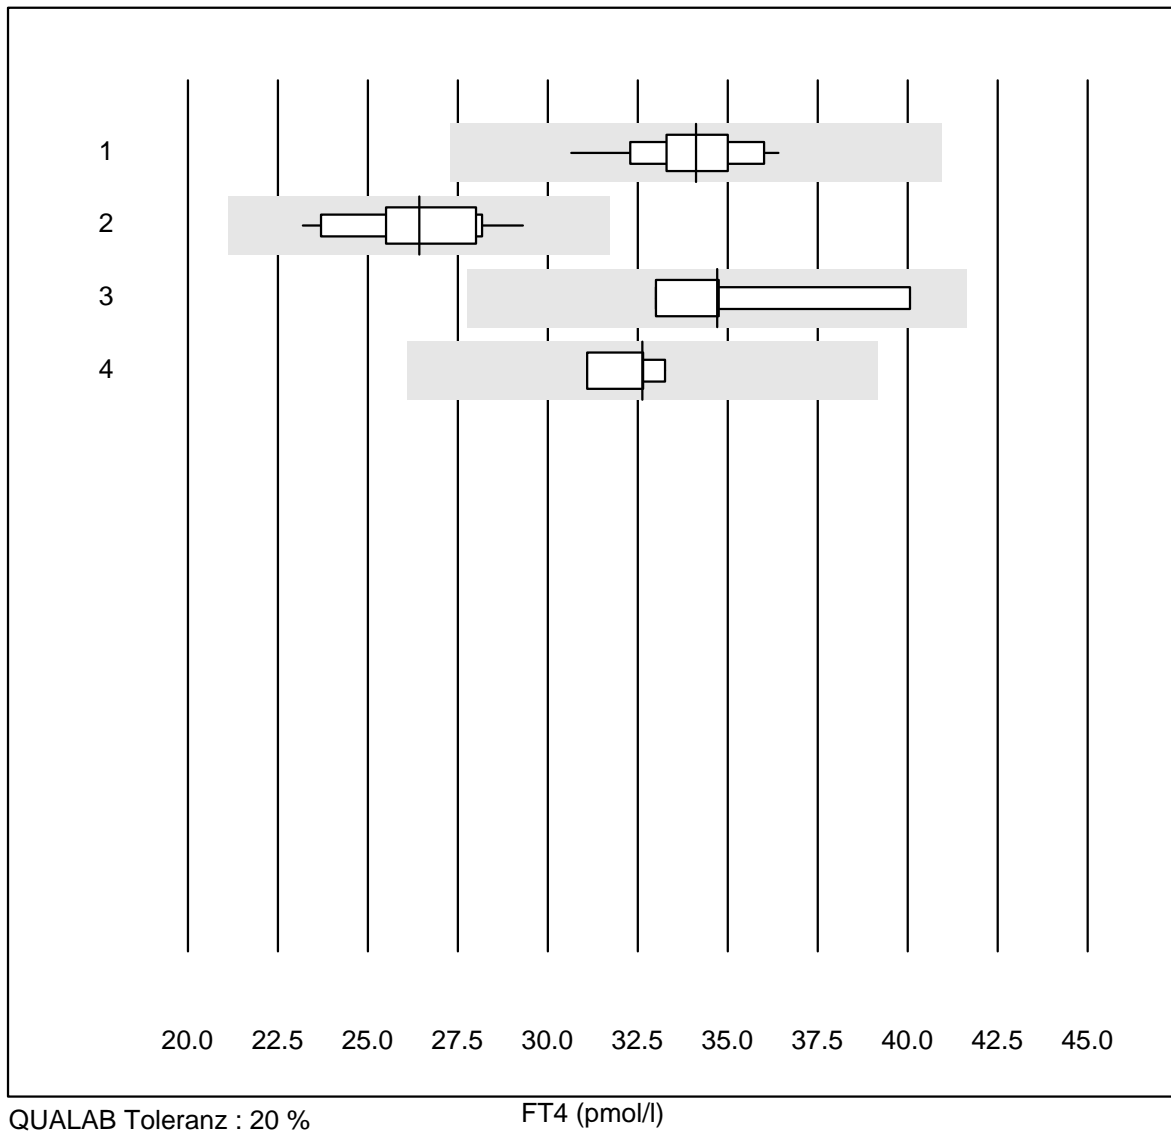
FT4

QUALAB Toleranz : 20 %

FT4 (pmol/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	15	100.0	0.0	0.0	34.1	4.4	e
2 Architect	11	100.0	0.0	0.0	26.4	7.1	e
3 VIDAS	8	100.0	0.0	0.0	34.7	6.6	a
4 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	32.6	2.8	e

Testostérone

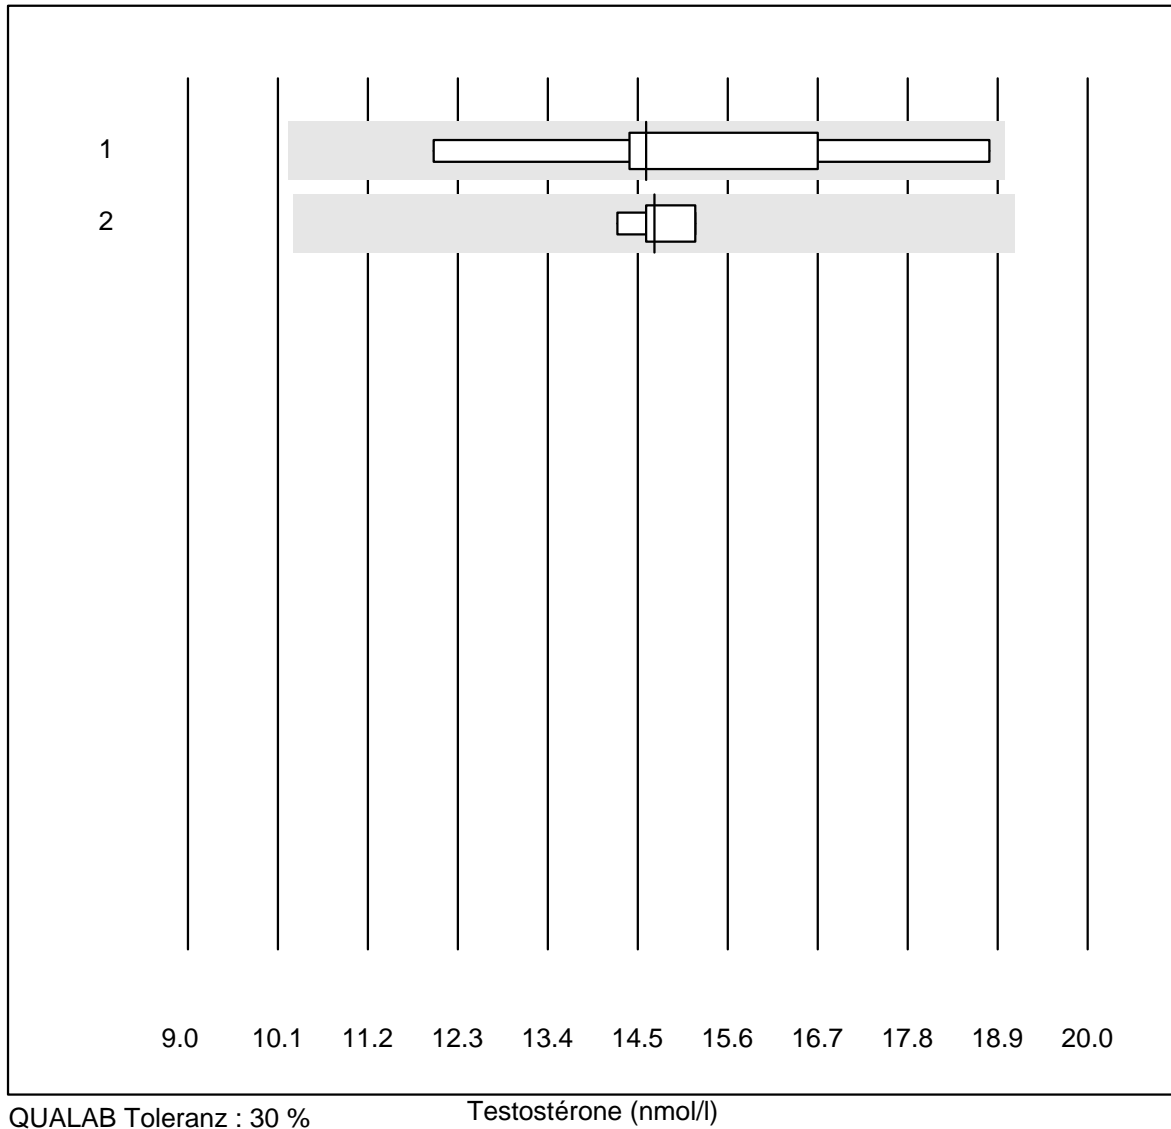

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	14.6	16.8	e*
2 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	14.7	2.8	e

Estradiol

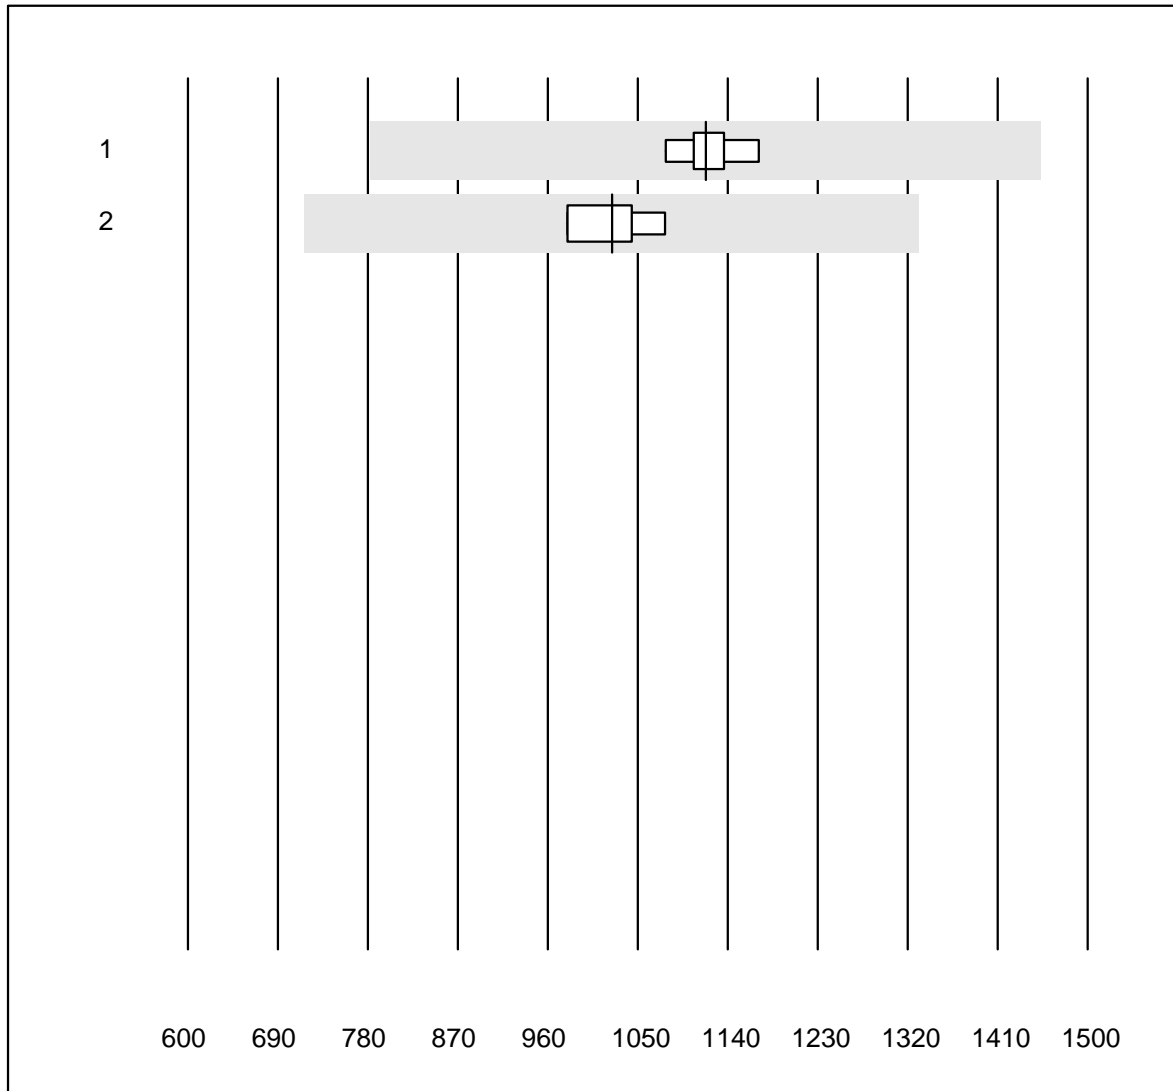


QUALAB Toleranz : 30 %

Estradiol (pmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	6	100.0	0.0	0.0	1118	2.8	e
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	1024	4.2	e

SHBG

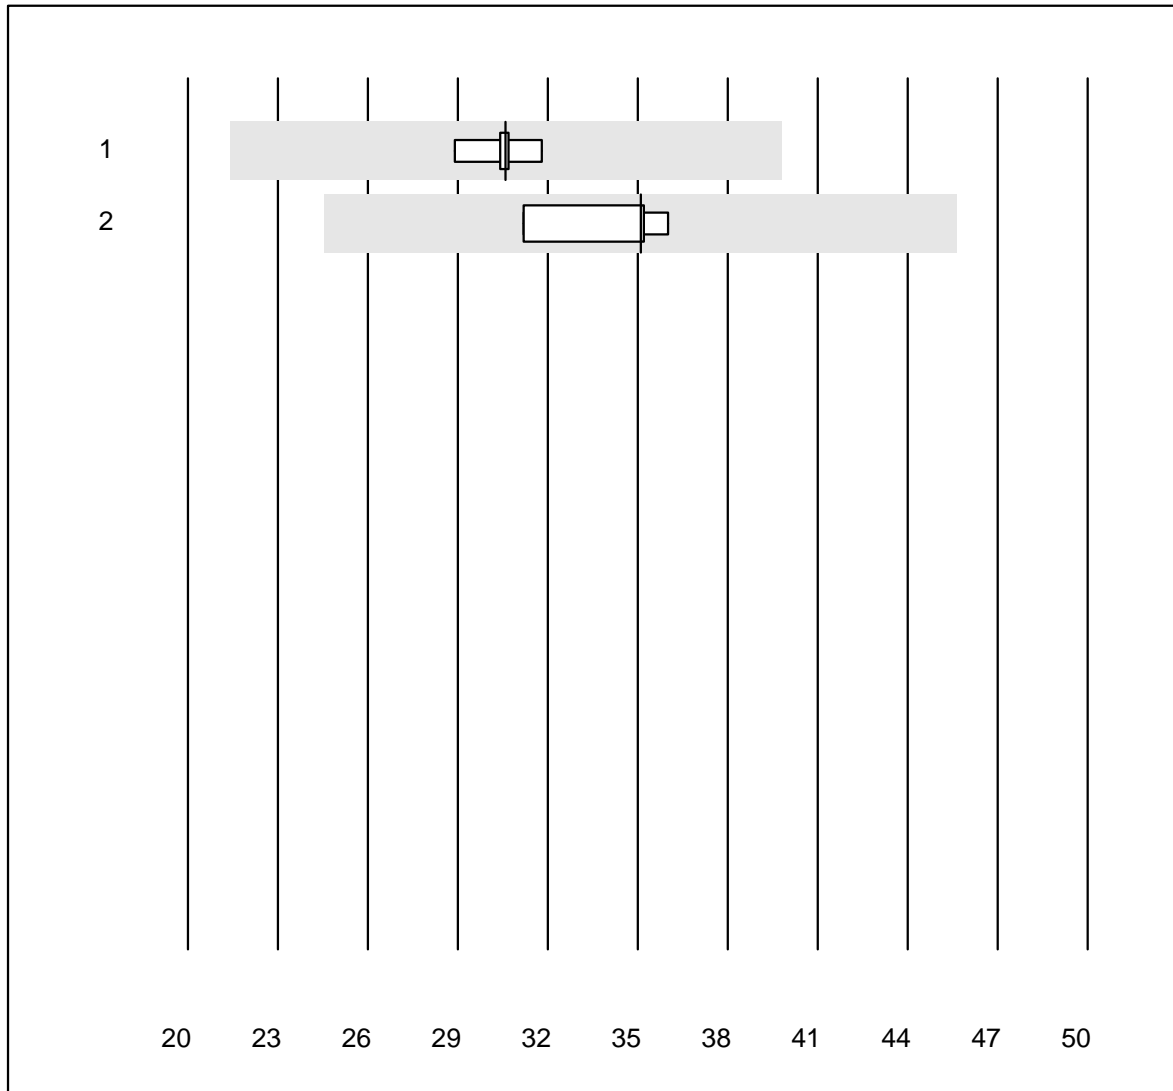


Tolérance MQ : 30 %

SHBG (nmol/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	30.6	3.4	e
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	35.1	6.2	e

Cortisol

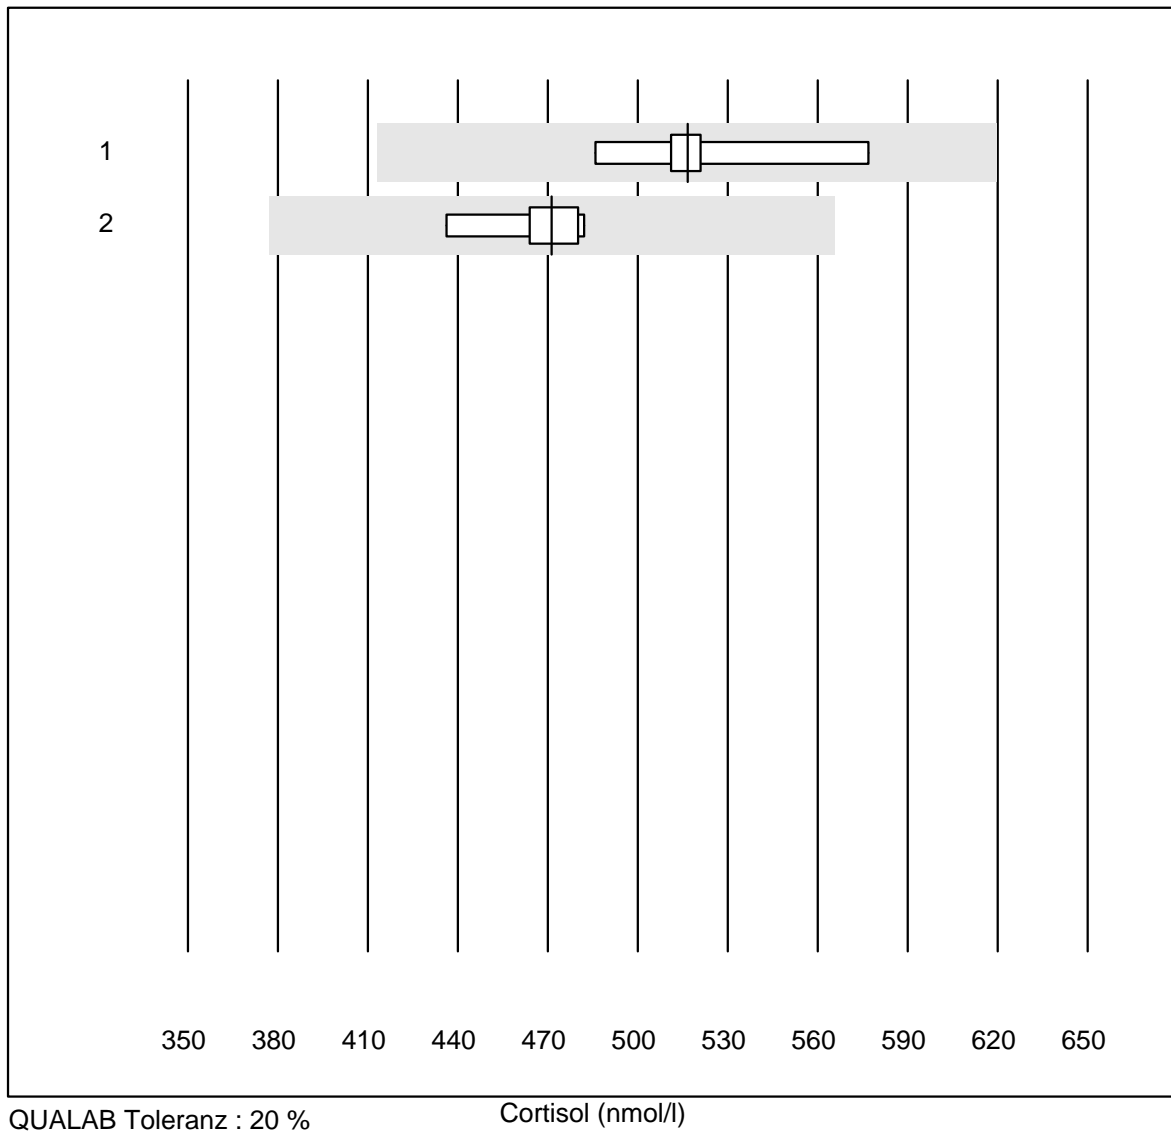

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	8	100.0	0.0	0.0	517	4.9	e
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	471	4.0	e

DHEAS

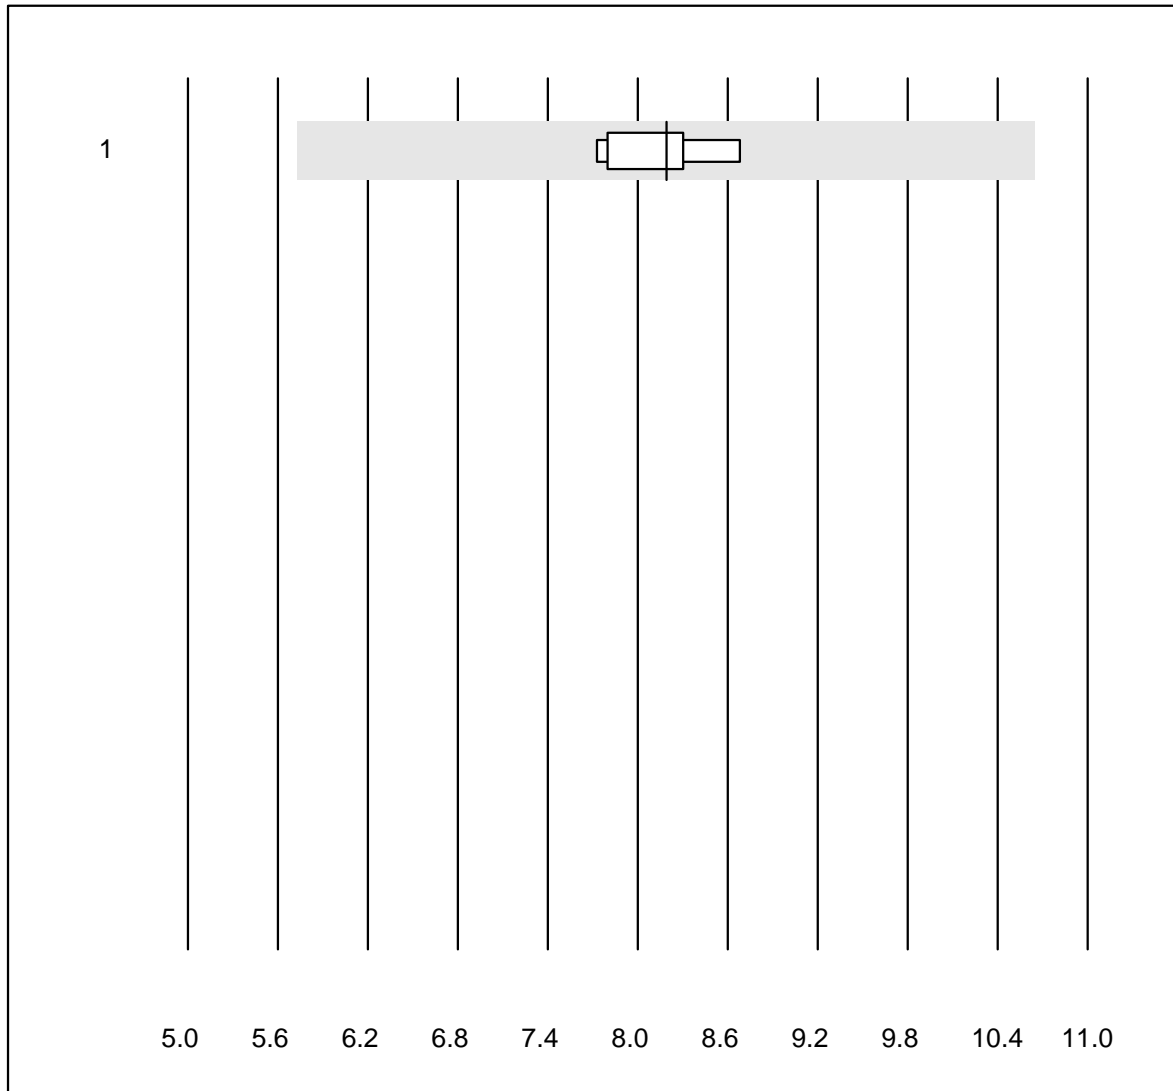


Tolérance MQ : 30 %

DHEAS (µmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	8.19	4.8	e

Luteinisierendes Hormon

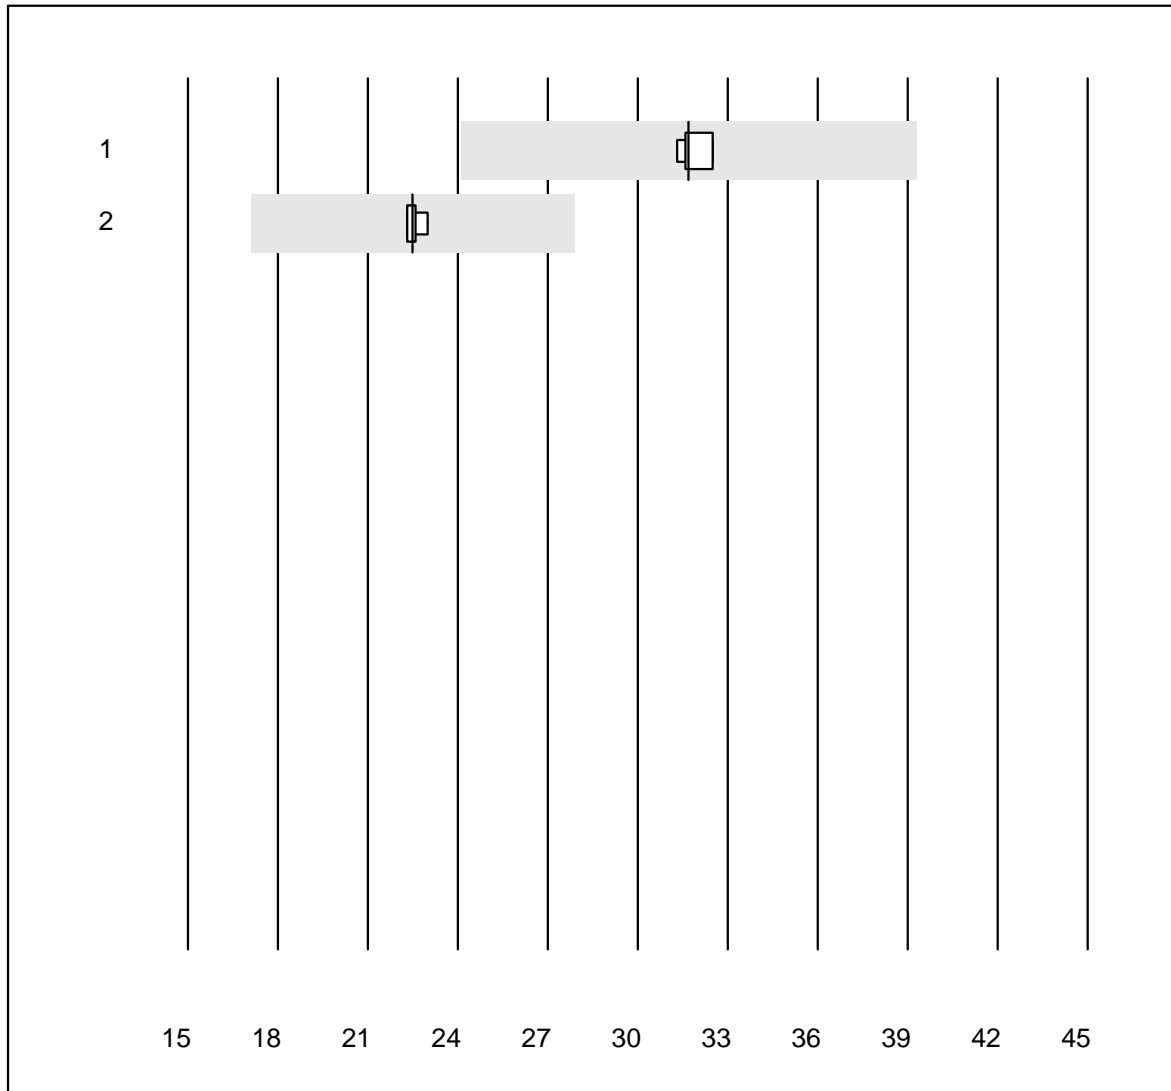


QUALAB Toleranz : 24 %

Luteinisierendes Hormon (U/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Roche, Cobas	7	100.0	0.0	0.0	31.7	1.5	e
2	Architect	4	100.0	0.0	0.0	22.5	1.4	e

Follikelstimulierendes Hormon

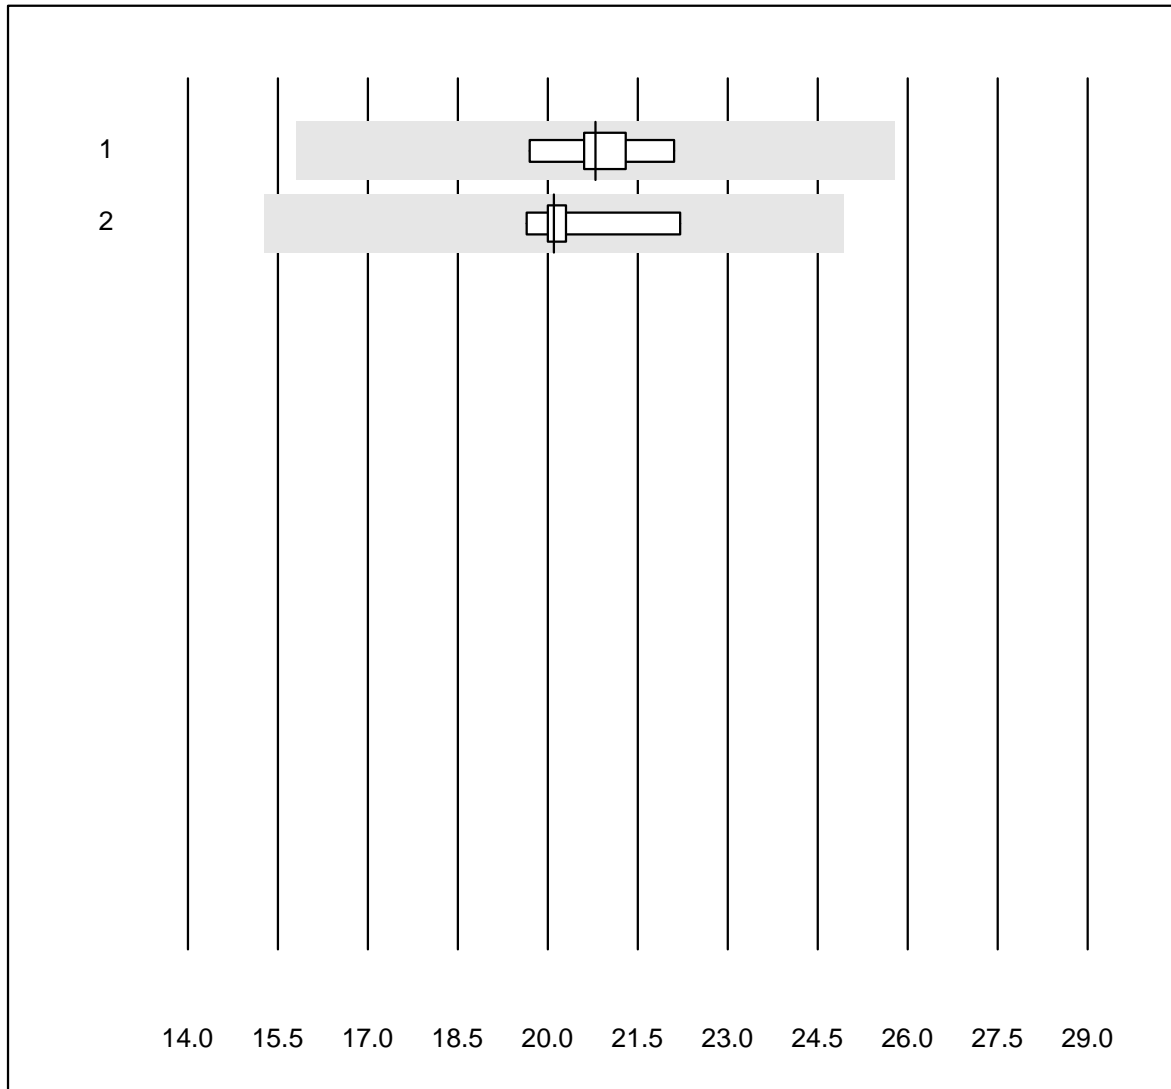


QUALAB Toleranz : 24 %

Follikelstimulierendes Hormon (U/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Roche, Cobas	7	100.0	0.0	0.0	20.8	3.5	e
2	Architect	5	100.0	0.0	0.0	20.1	4.9	e

Prolaktin (PRL)

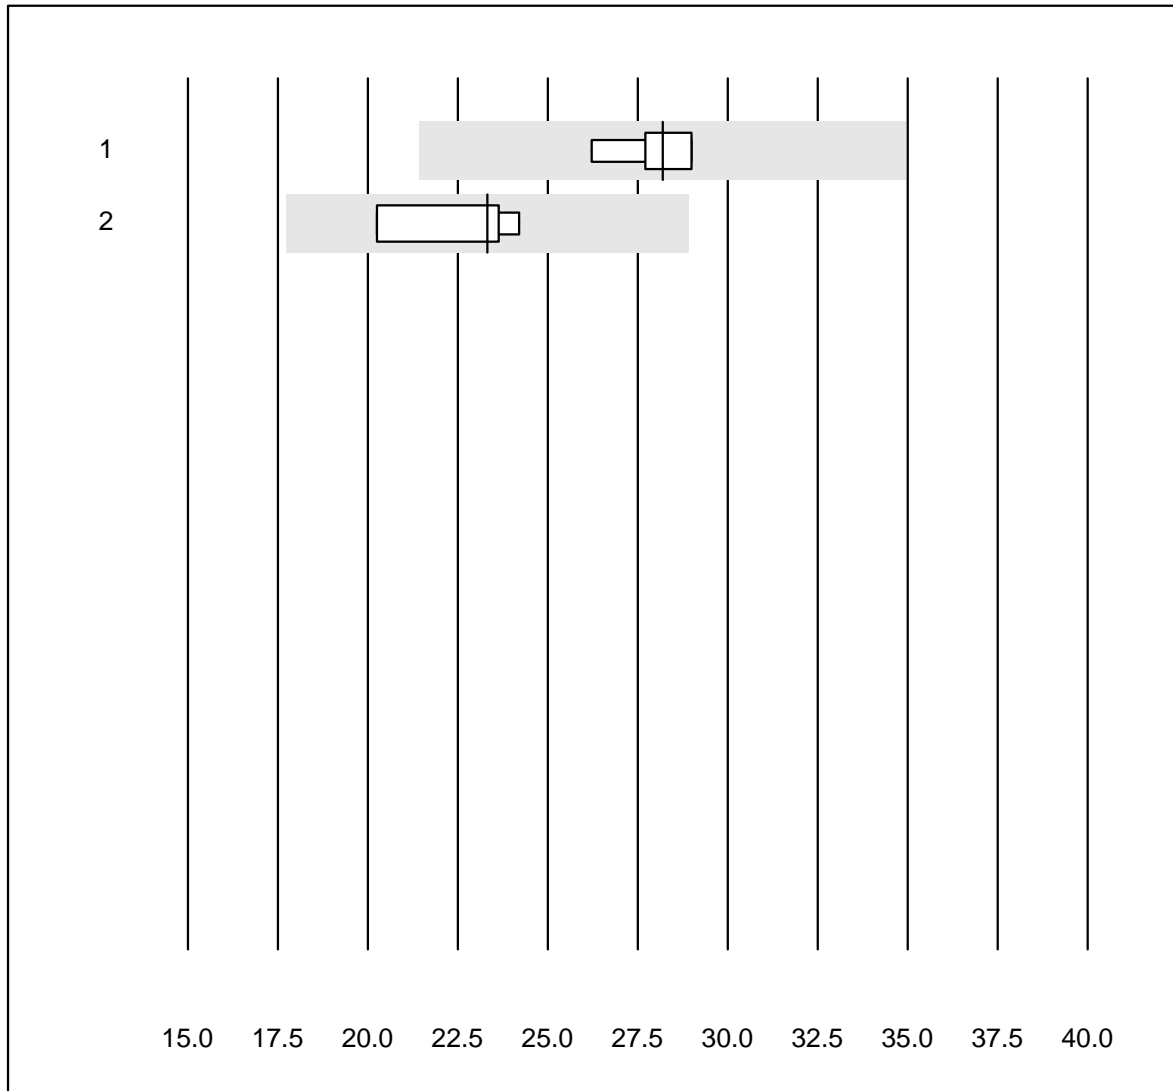


QUALAB Toleranz : 24 %

Prolaktin (PRL) (µg/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas/Roche	7	100.0	0.0	0.0	28.2	3.5	e
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	23.3	7.7	e*

Insulin

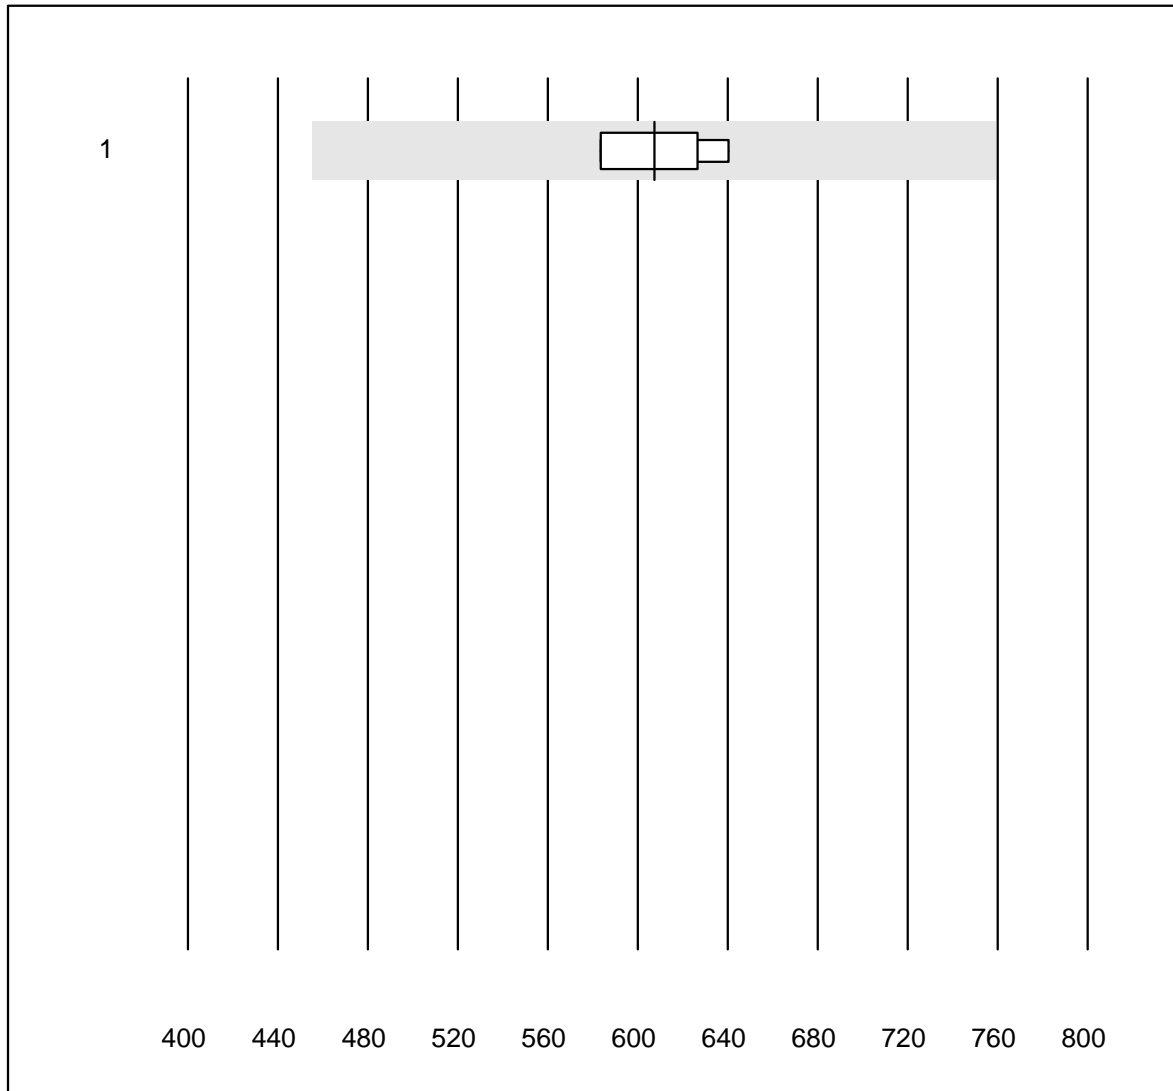


Tolérance MQ : 25 %

Insulin (pmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	607	4.6	e

HGH

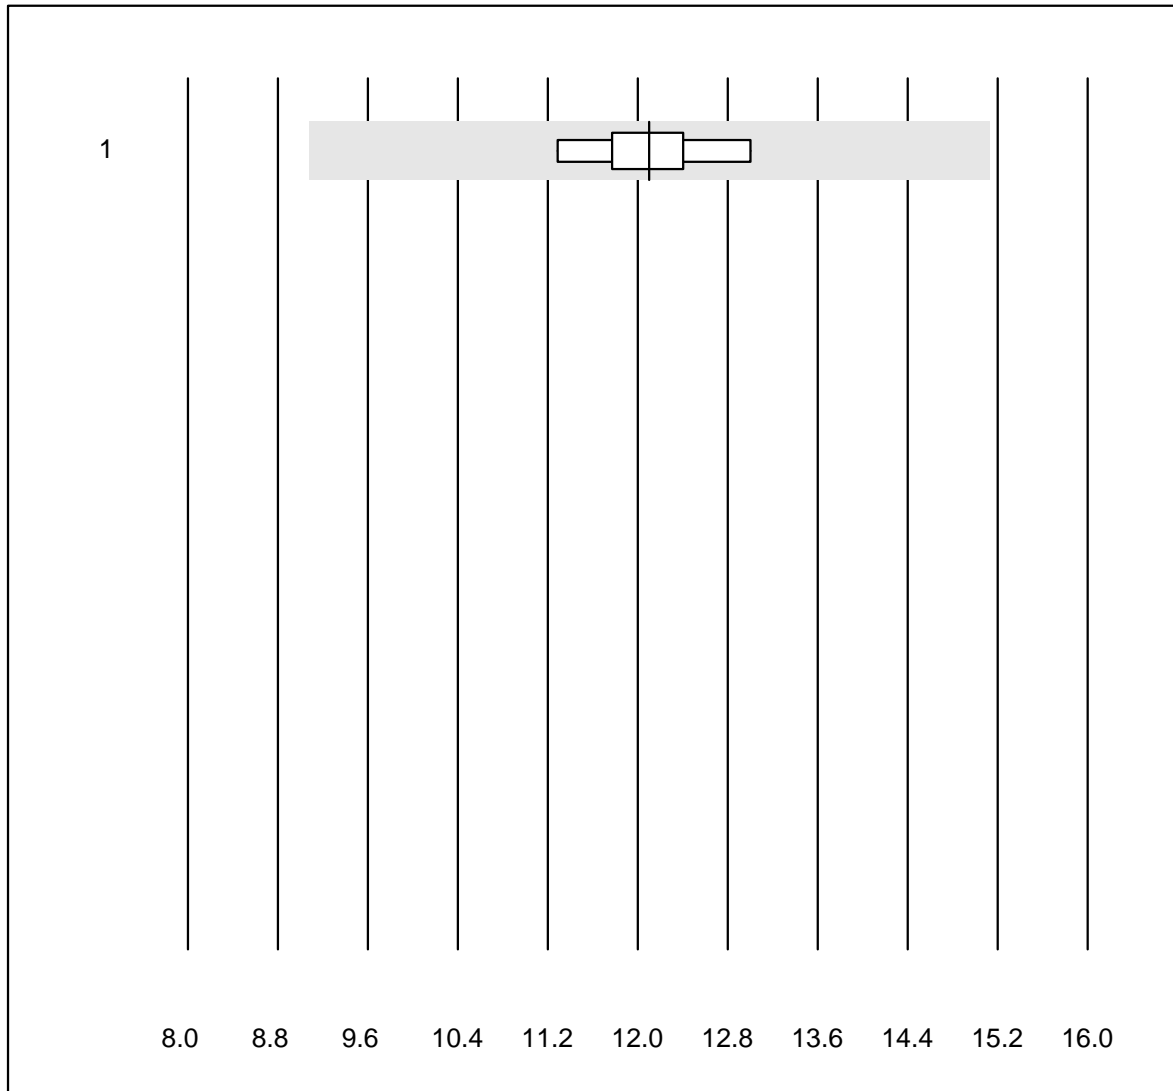


Tolérance MQ : 25 %

HGH (µg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	12.10	4.9	e

IGF-1

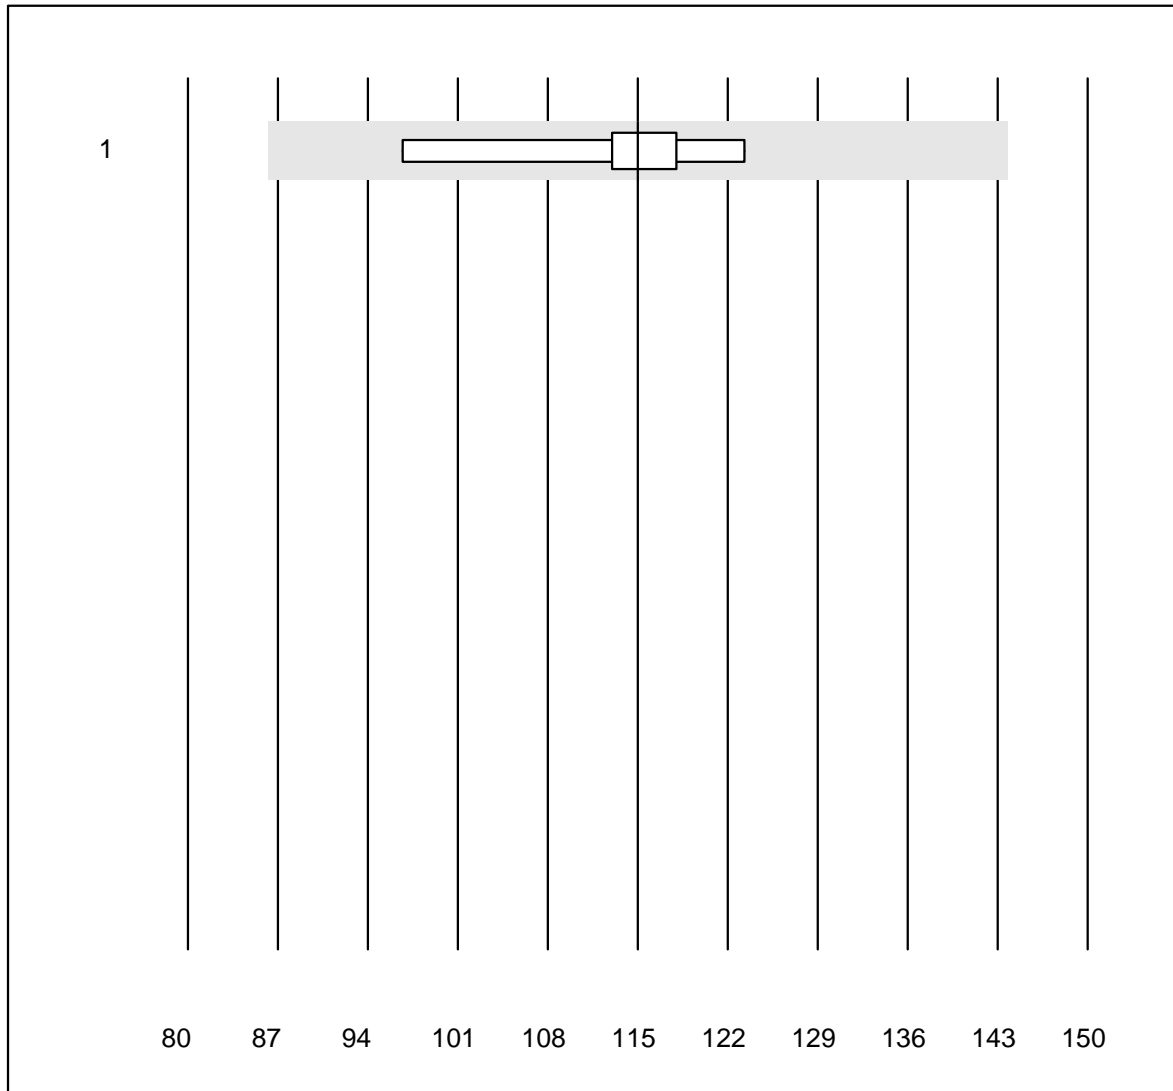


Tolérance MQ : 25 %

IGF-1 (µg/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Liaison	5	100.0	0.0	0.0	115	8.8	e*

Troponine T CR

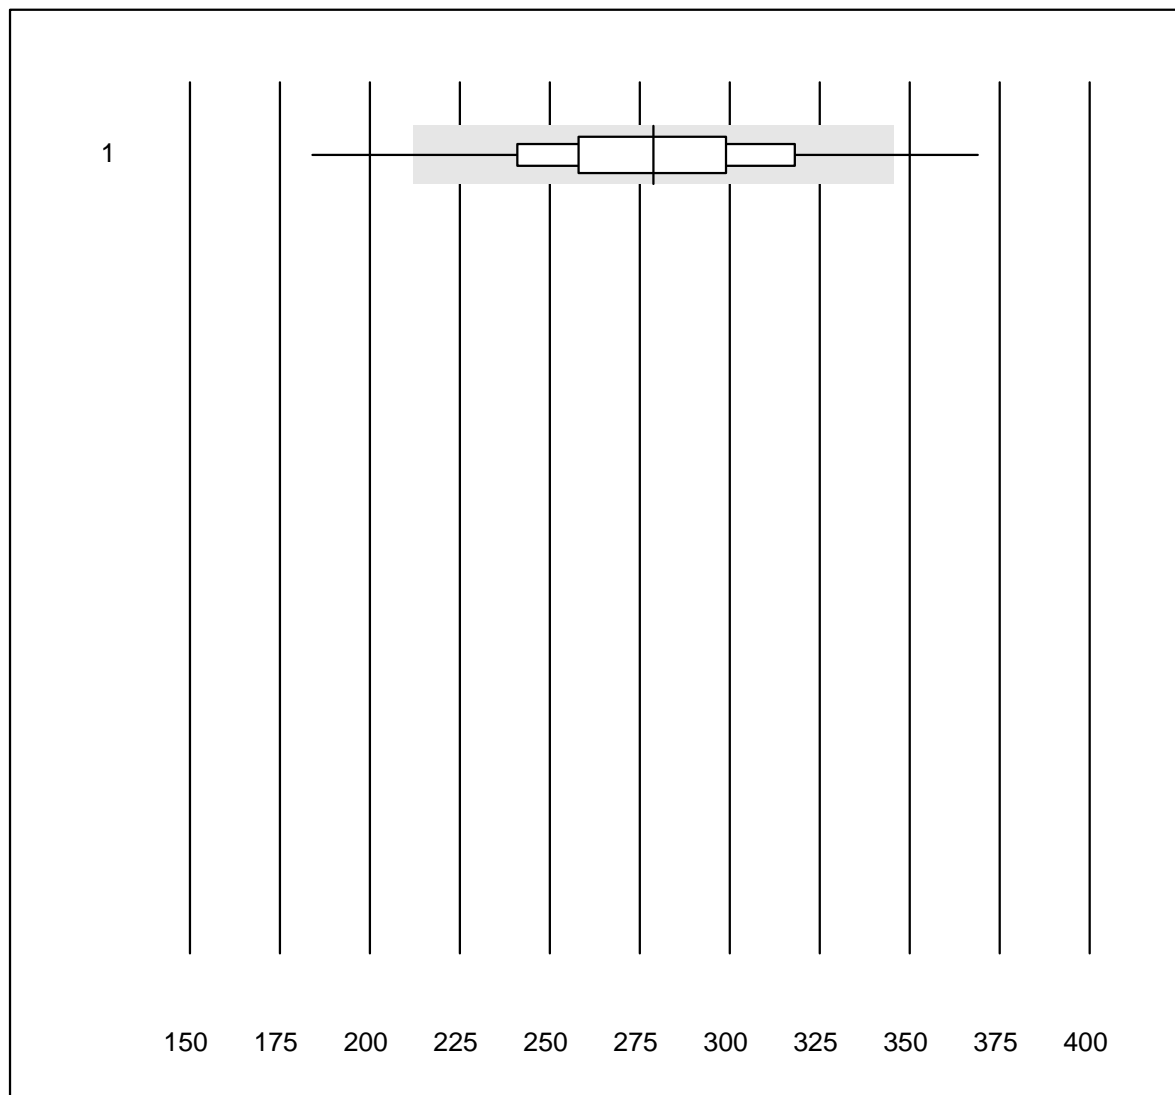


QUALAB Toleranz : 24 %

Troponine T CR (ng/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas h 232	1303	96.6	2.5	0.9	278.78	10.7	e

D-Dimères CR

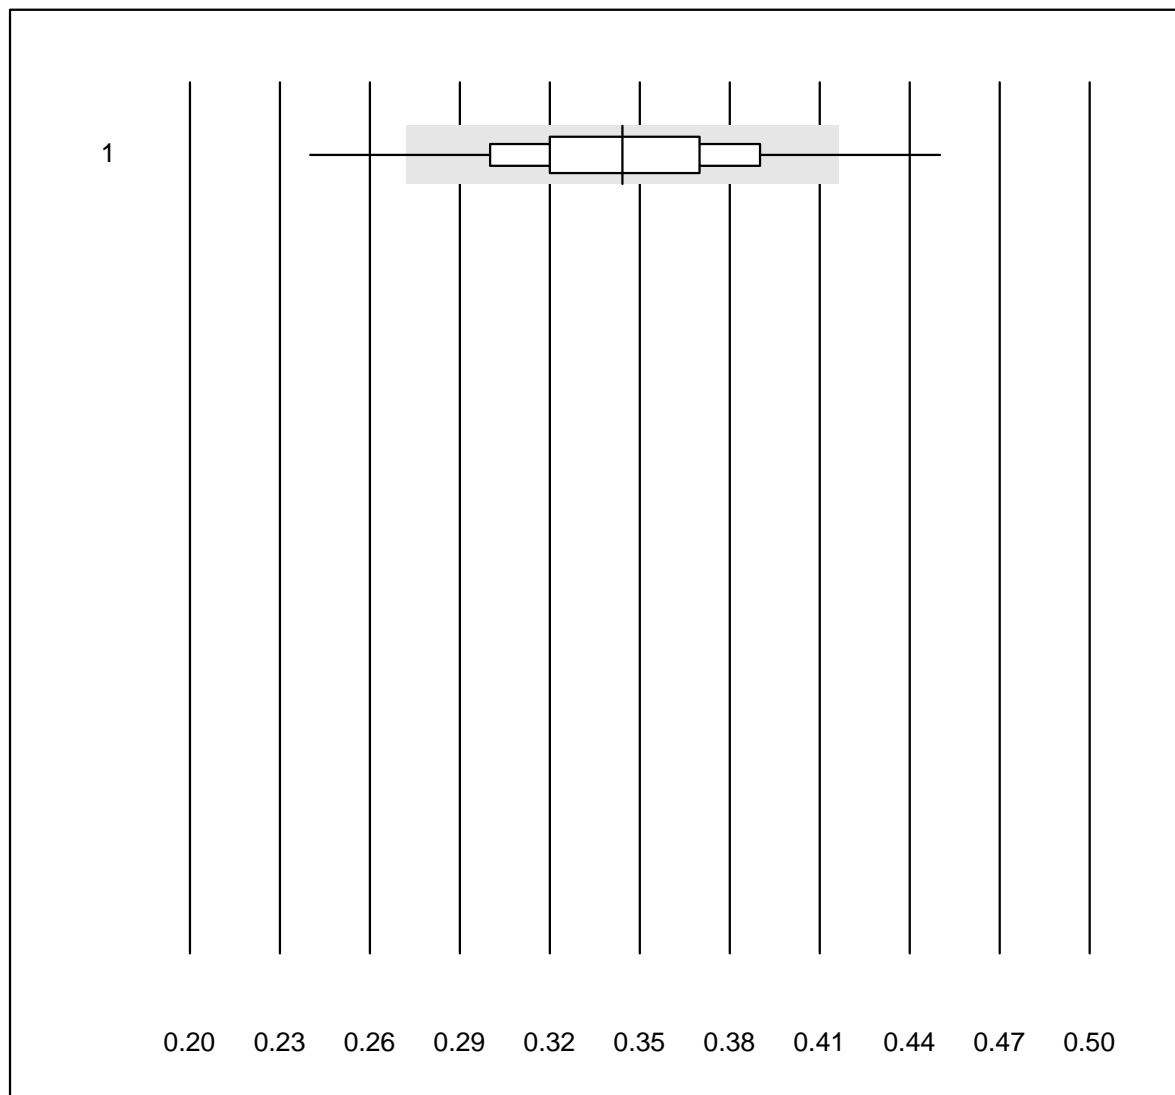


QUALAB Toleranz : 21 %

D-Dimères CR (mg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas h 232	1288	96.8	2.6	0.6	0.34	9.2	e

CKMB- K8

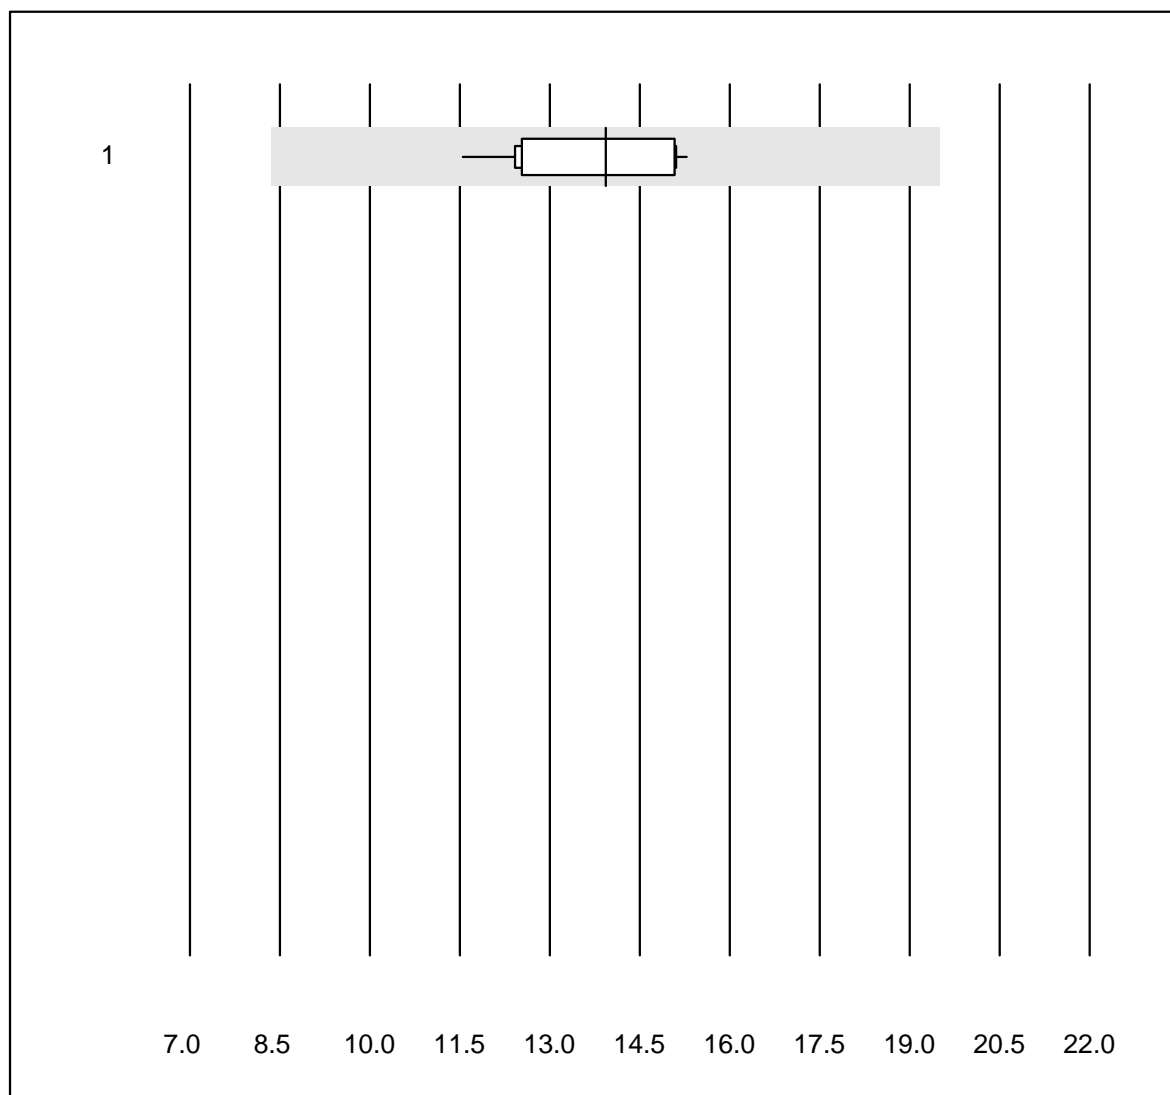


Tolérance MQ : 40 %

CKMB- K8 (µg/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas h 232	11	100.0	0.0	0.0	13.9	8.9	e

NT-proBNP CR

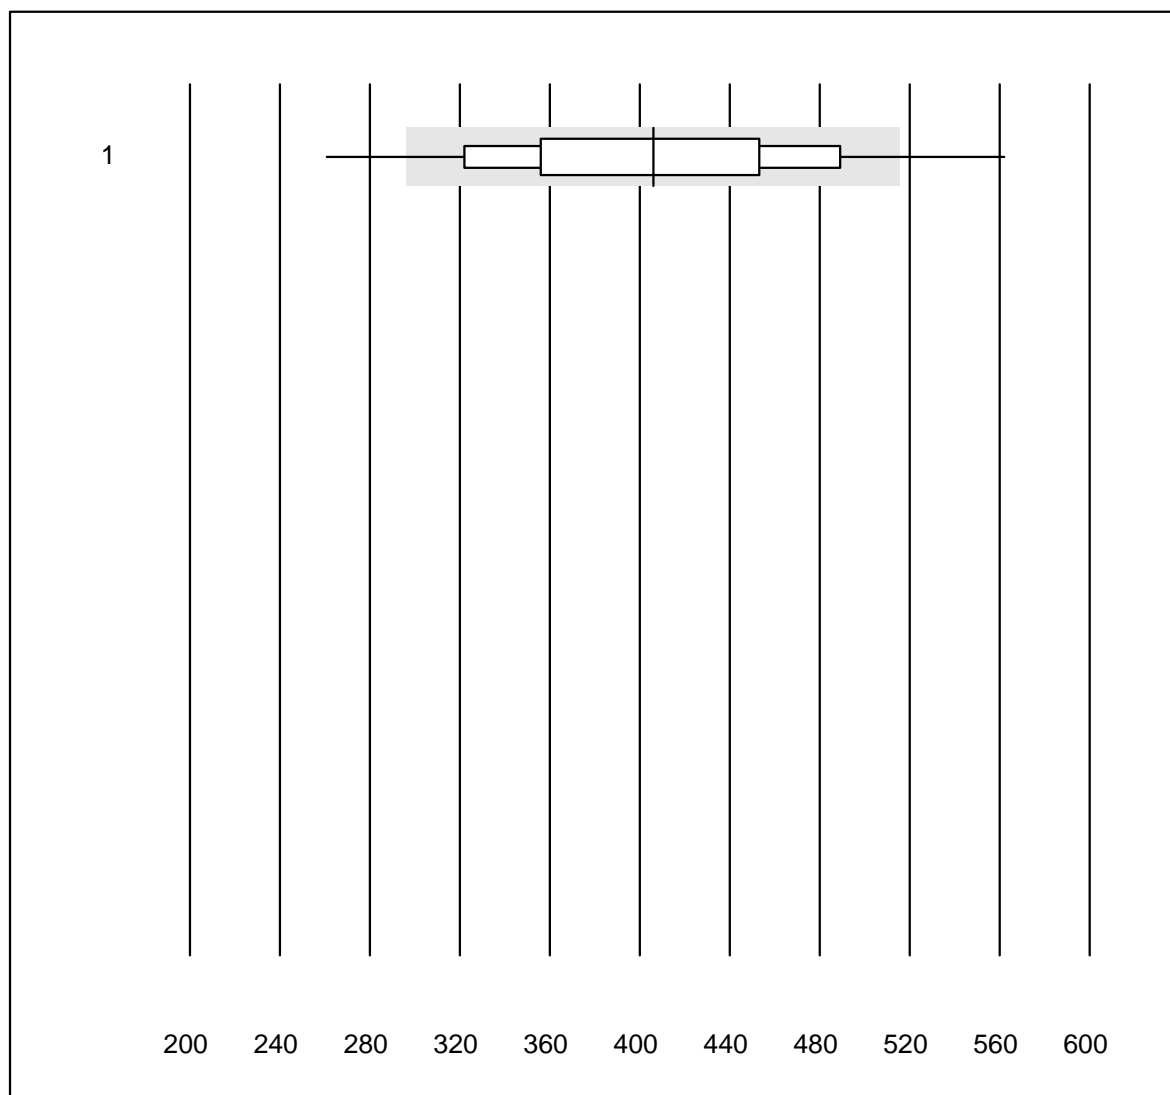


QUALAB Toleranz : 27 %

NT-proBNP CR (ng/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas h 232	823	91.7	7.4	0.9	406	15.5	e

PCO2 CCA

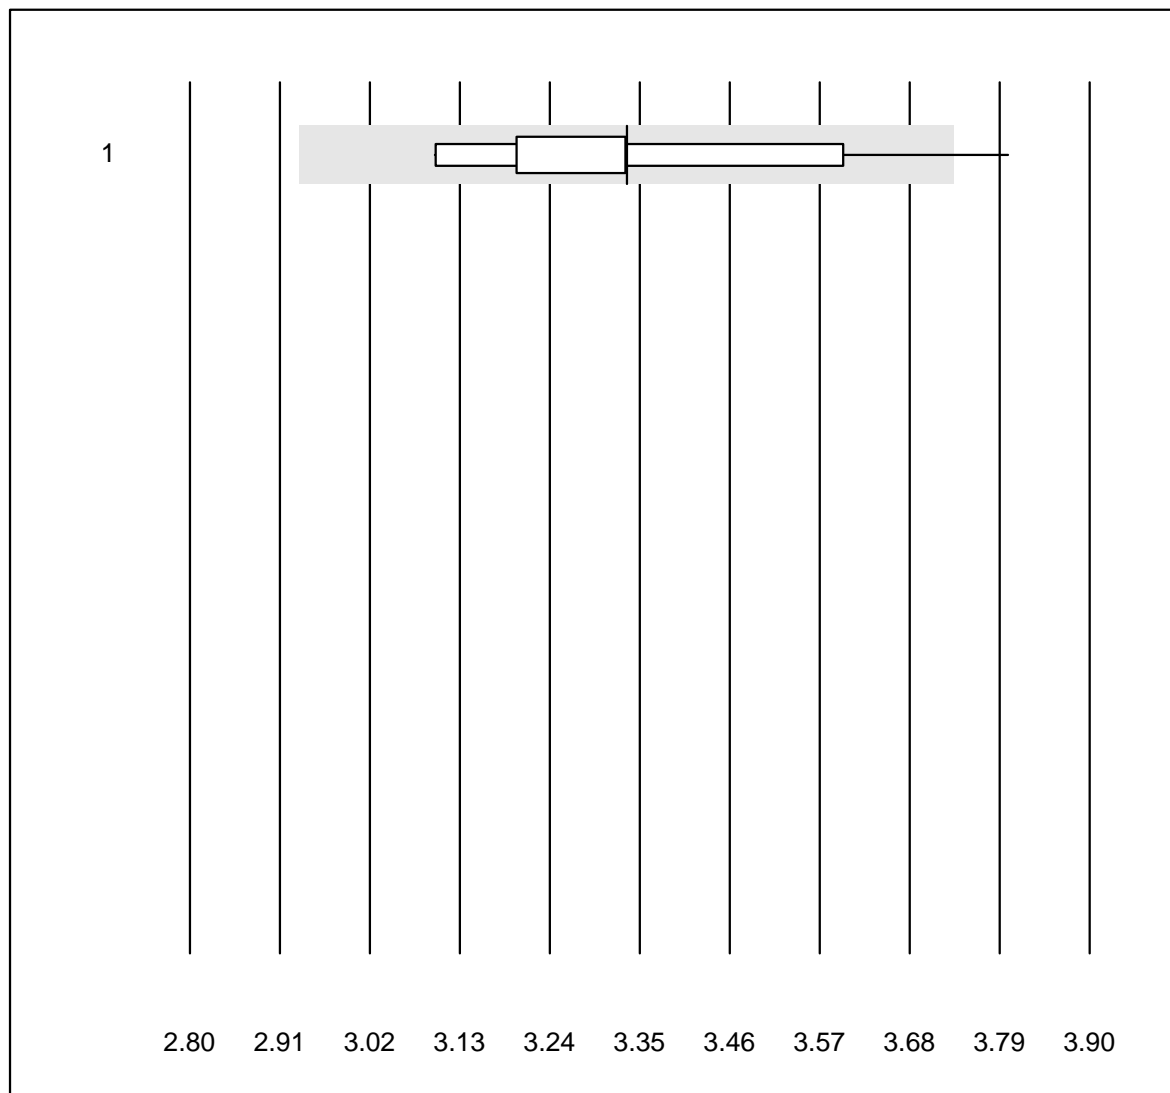


QUALAB Toleranz : 12 %

PCO2 CCA (kPa)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 OPTI CCA	12	91.7	8.3	0.0	3.33	6.3	e*

PO2 CCA

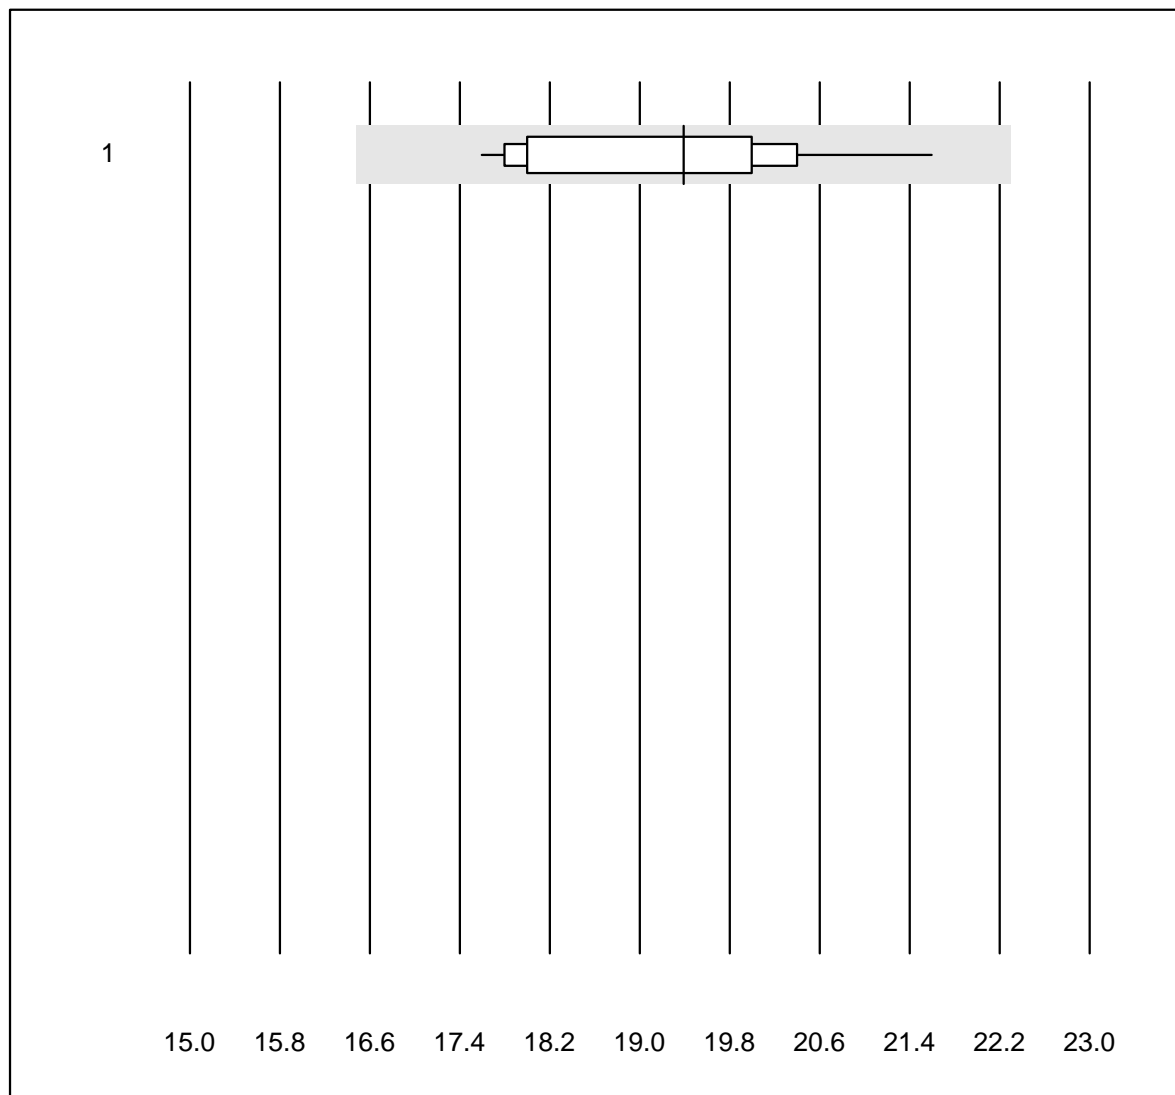


QUALAB Toleranz : 15 %

PO2 CCA (kPa)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 OPTI CCA	12	100.0	0.0	0.0	19.39	6.0	e

pH CCA

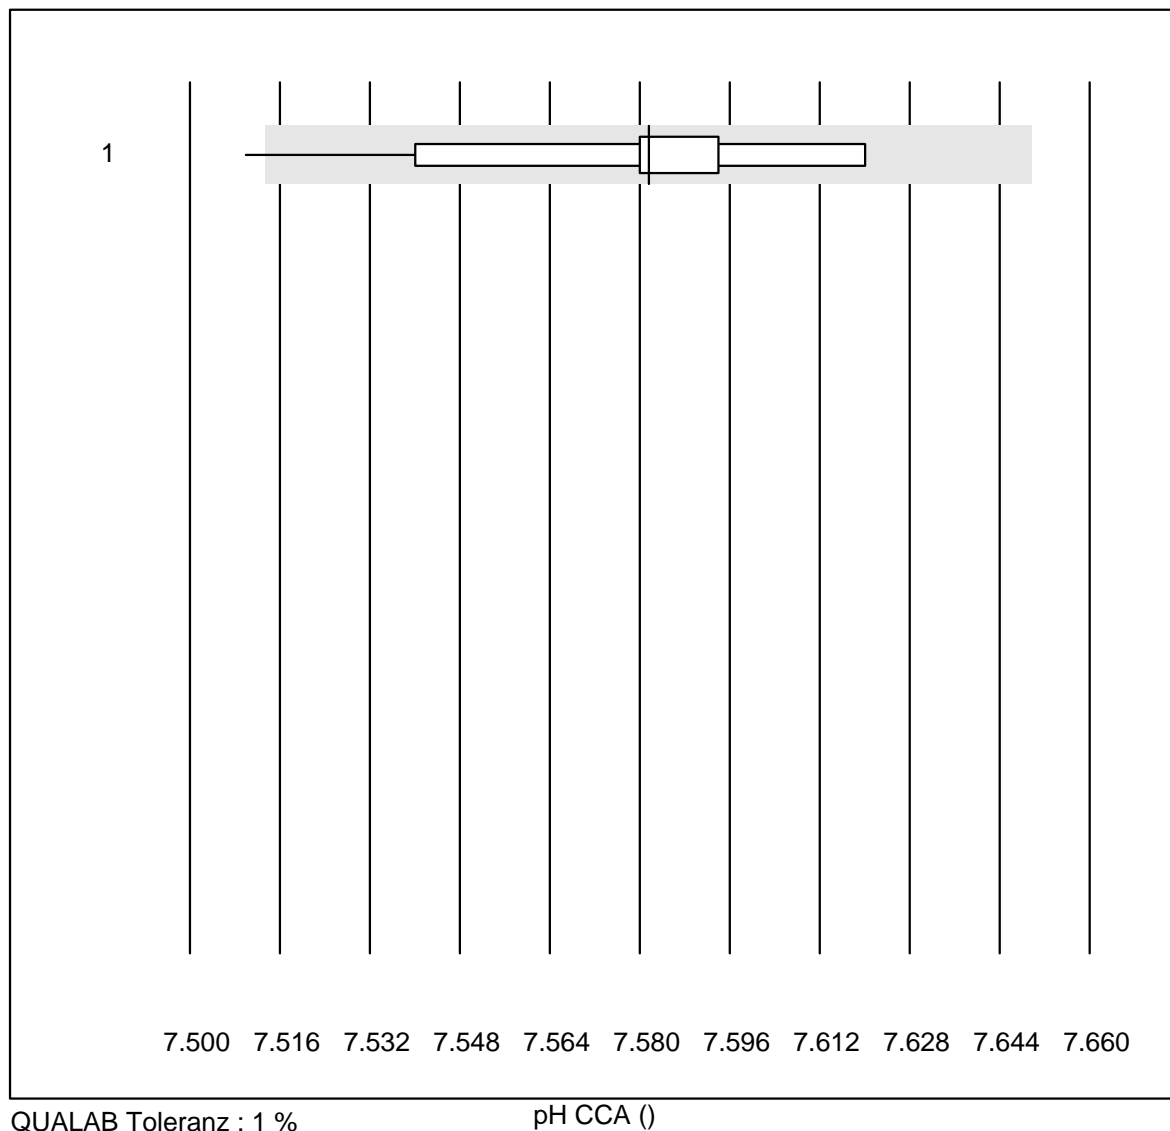

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 OPTI CCA	11	90.9	9.1	0.0	7.58	0.4	e*

Potassium CCA

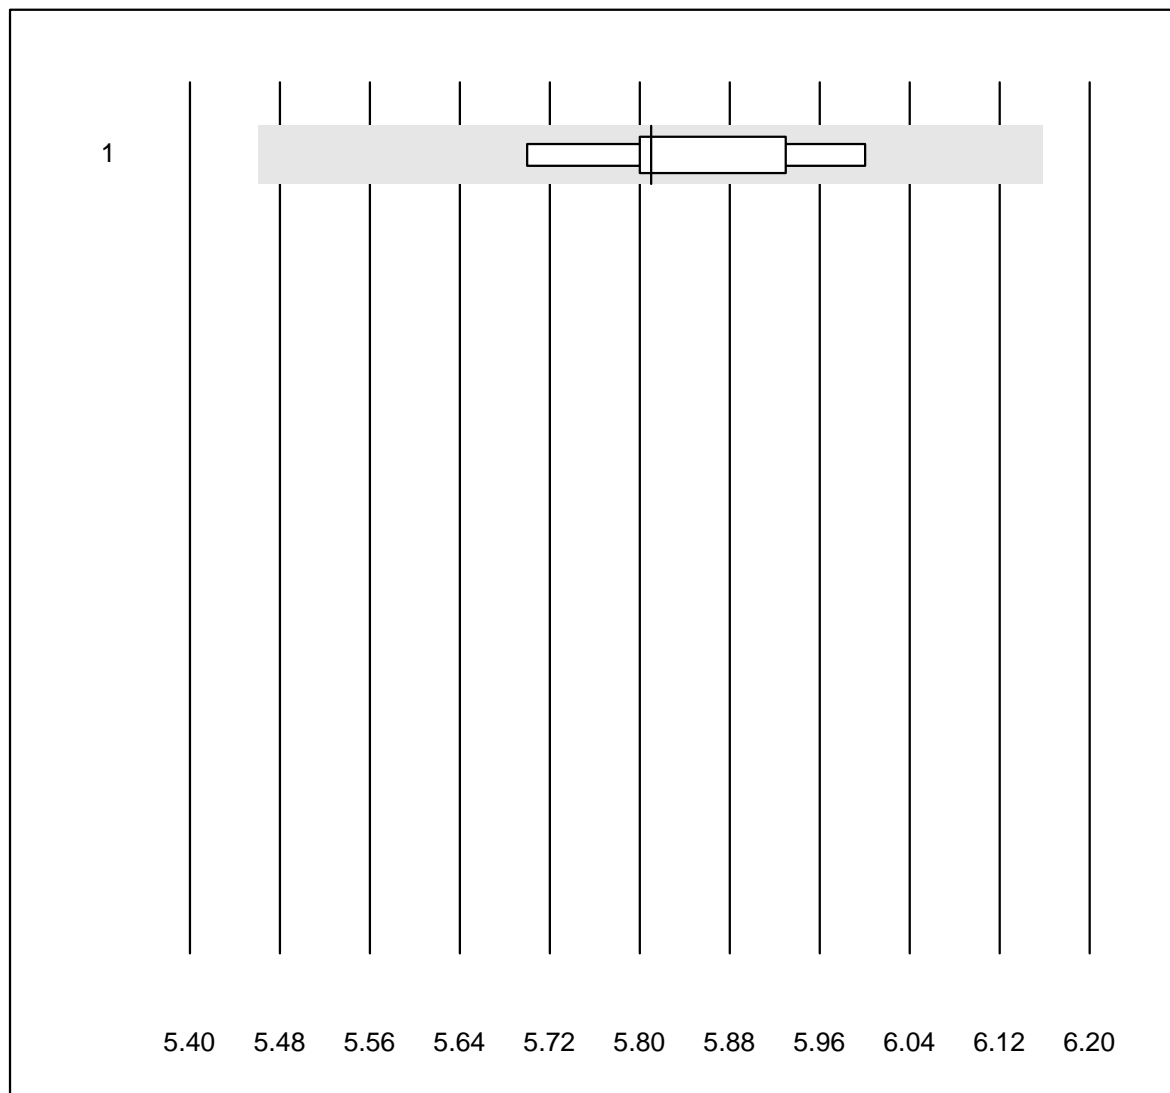


QUALAB Toleranz : 6 %

Potassium CCA (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 OPTI CCA	6	83.3	0.0	16.7	5.8	2.0	e*

Sodium CCA

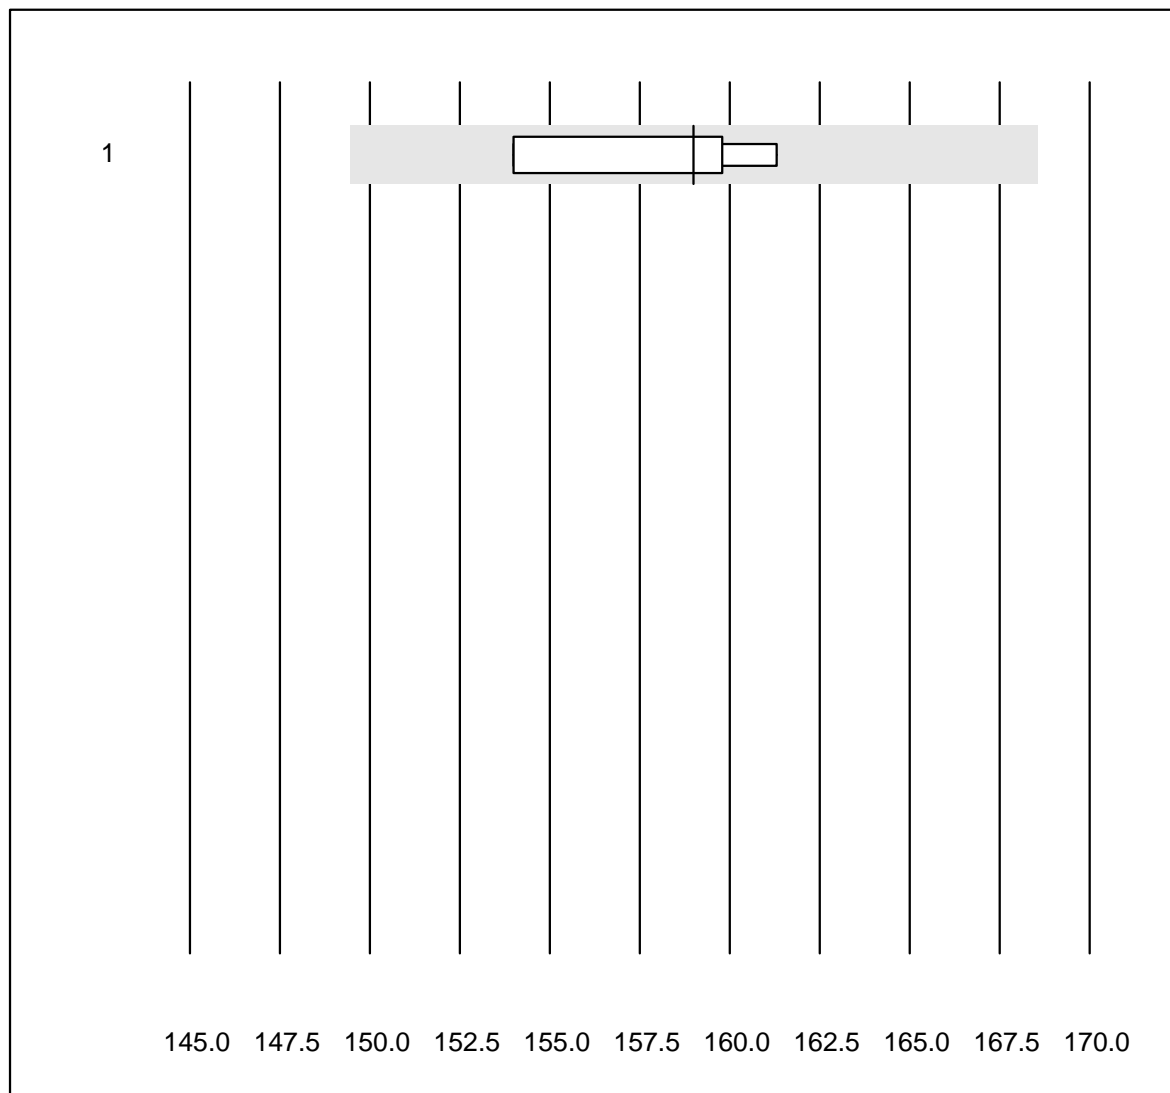


QUALAB Toleranz : 6 %

Sodium CCA (mmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	OPTI CCA	5	80.0	0.0	20.0	159.0	2.0	e*

Ferritine

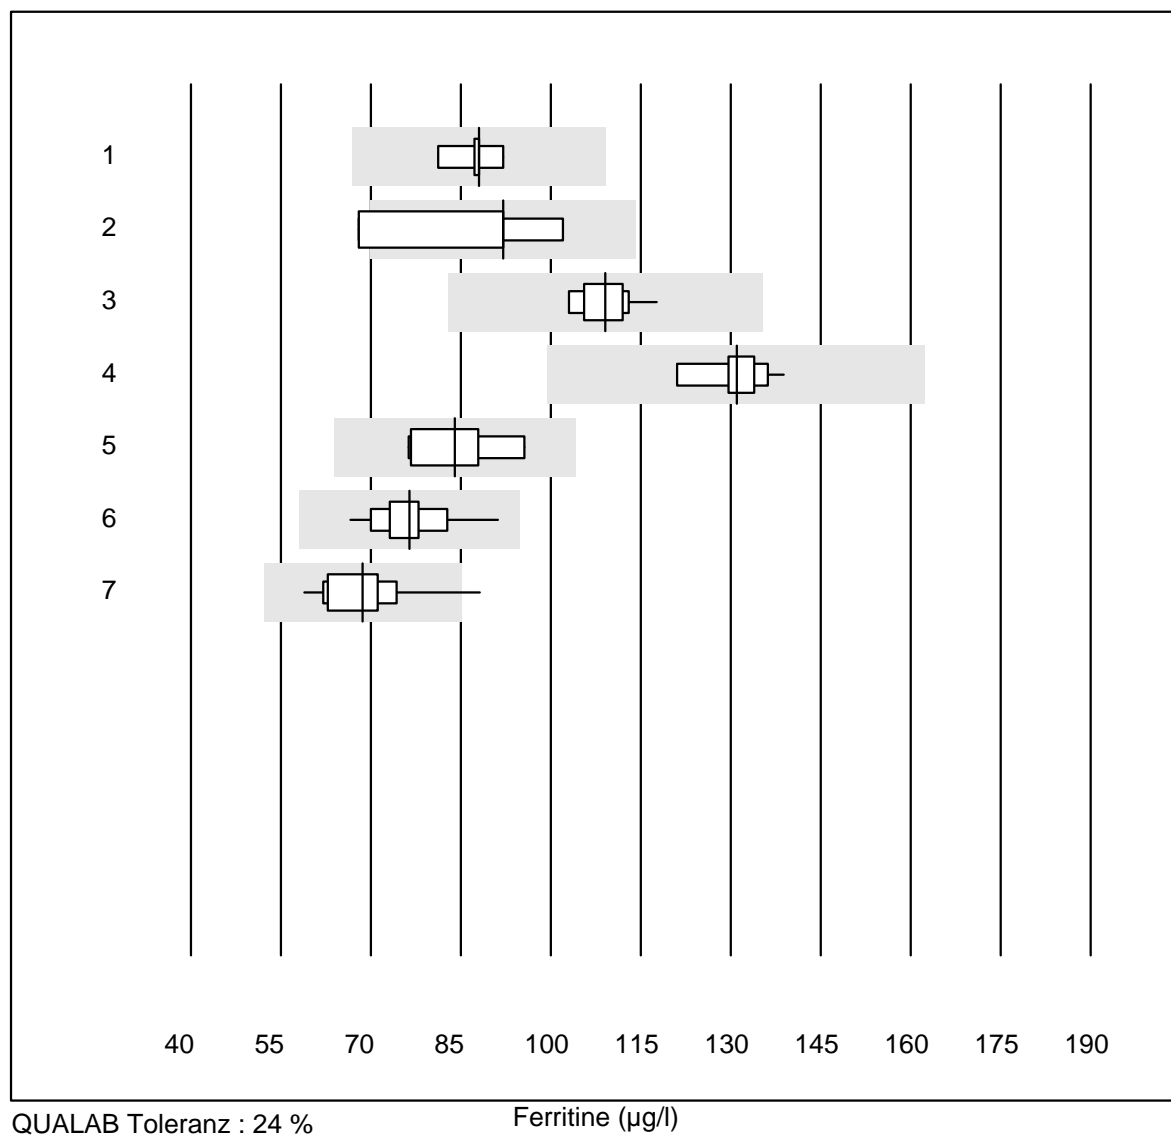

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Beckman	6	100.0	0.0	0.0	88.00	4.0	e
2	toutes les méthodes	5	60.0	20.0	20.0	92.00	18.2	e*
3	Cobas E / Elecsys	15	100.0	0.0	0.0	109.07	3.9	e
4	Architect	10	100.0	0.0	0.0	130.98	4.2	e
5	Mini Vidas	8	100.0	0.0	0.0	84.01	9.0	e*
6	AFIAS	46	100.0	0.0	0.0	76.40	6.2	e
7	Eurolyser	20	95.0	5.0	0.0	68.65	9.5	e

Vitamine B12

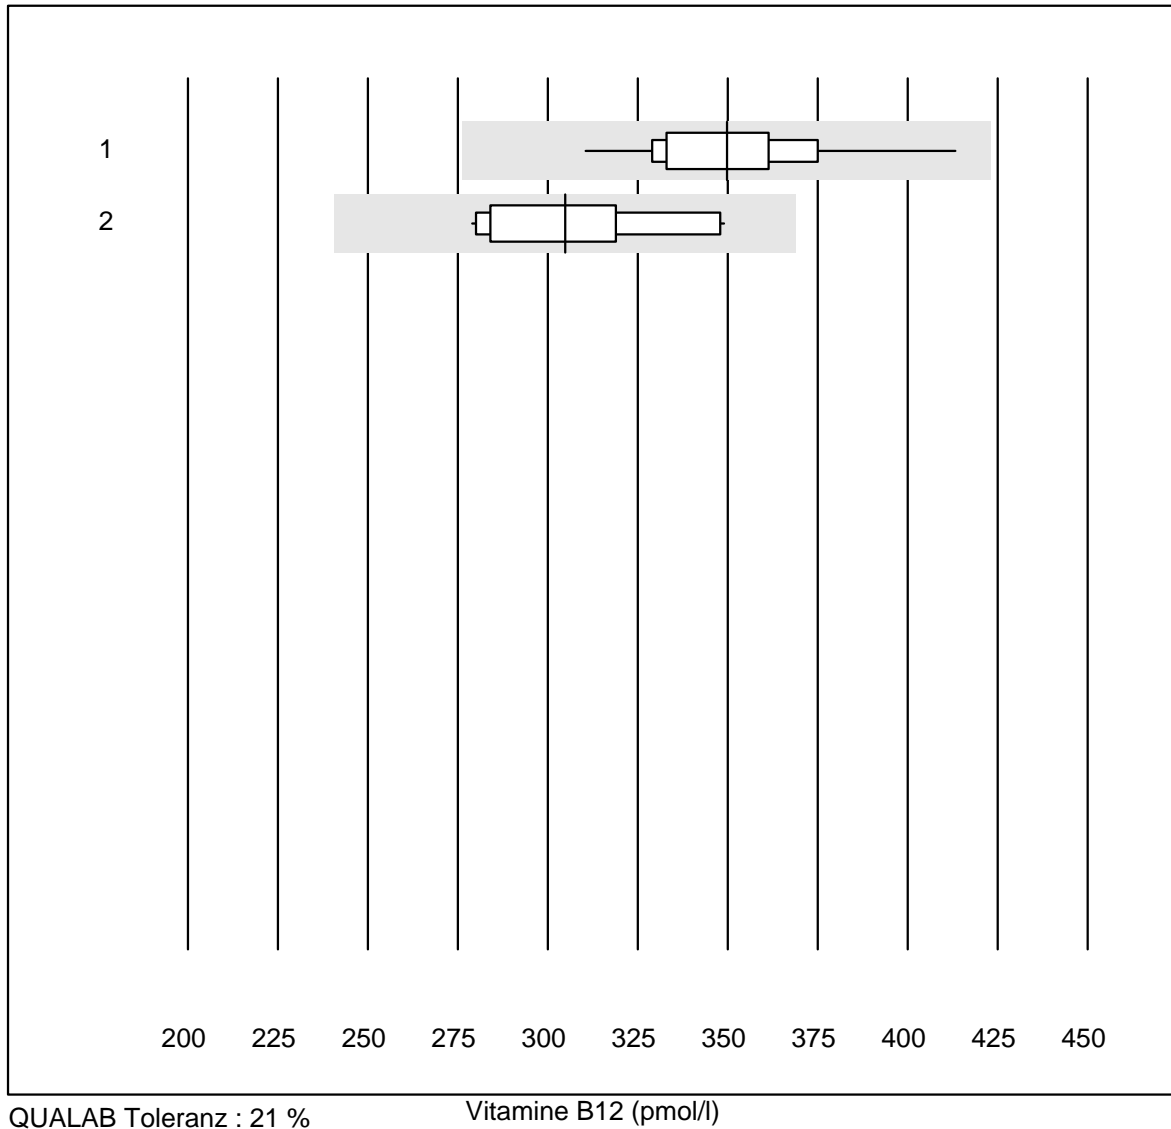


QUALAB Toleranz : 21 %

Vitamine B12 (pmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	13	100.0	0.0	0.0	349.71	7.3	e
2	Architect	11	100.0	0.0	0.0	304.88	8.1	e

Folate

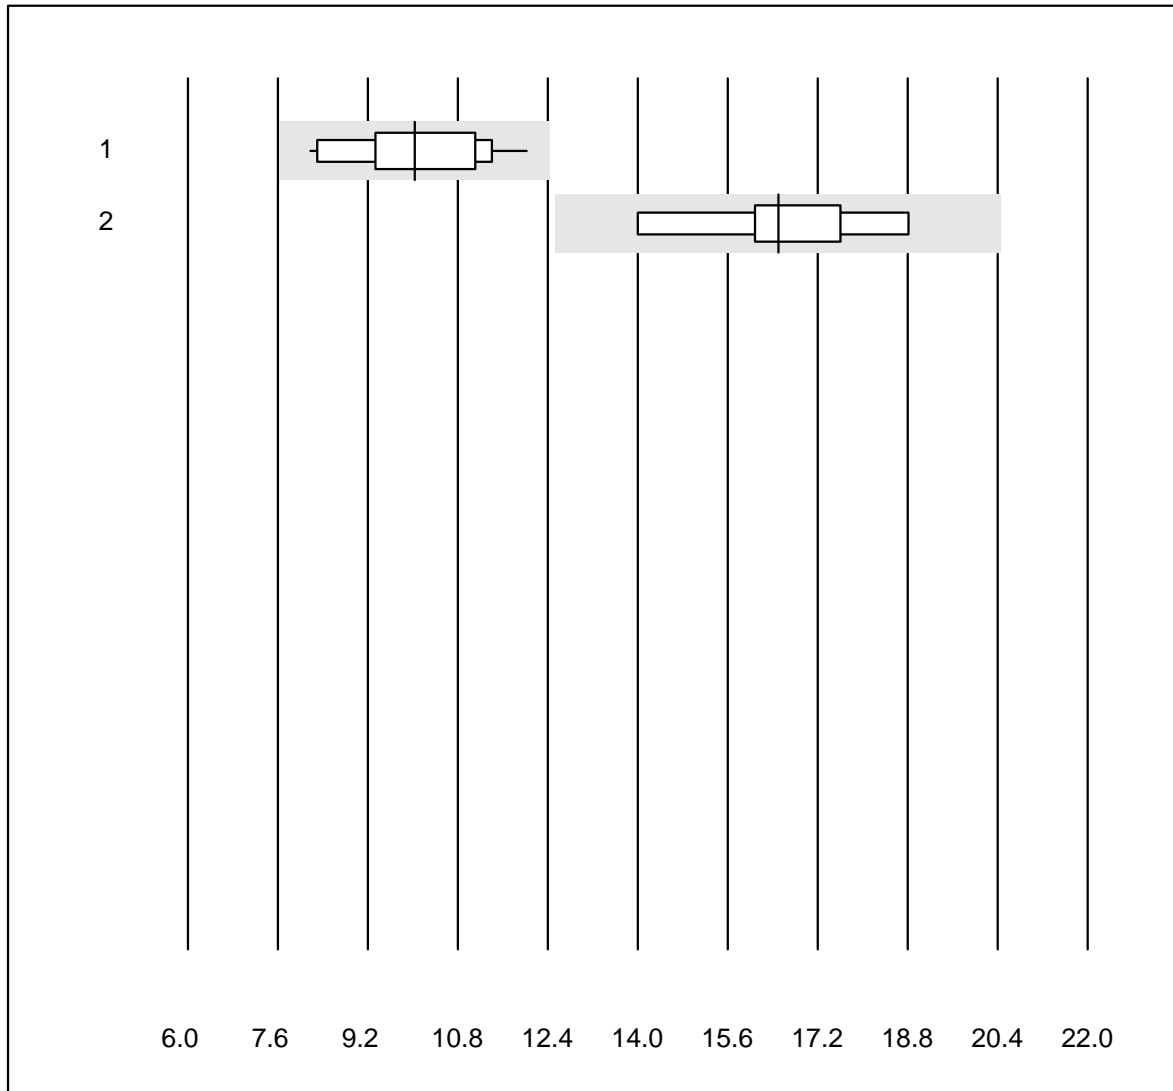


QUALAB Toleranz : 24 %

Folate (nmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	15	93.3	0.0	6.7	10.03	11.2	e*
2	Architect	9	100.0	0.0	0.0	16.50	9.8	e*

Holotranscobalamine

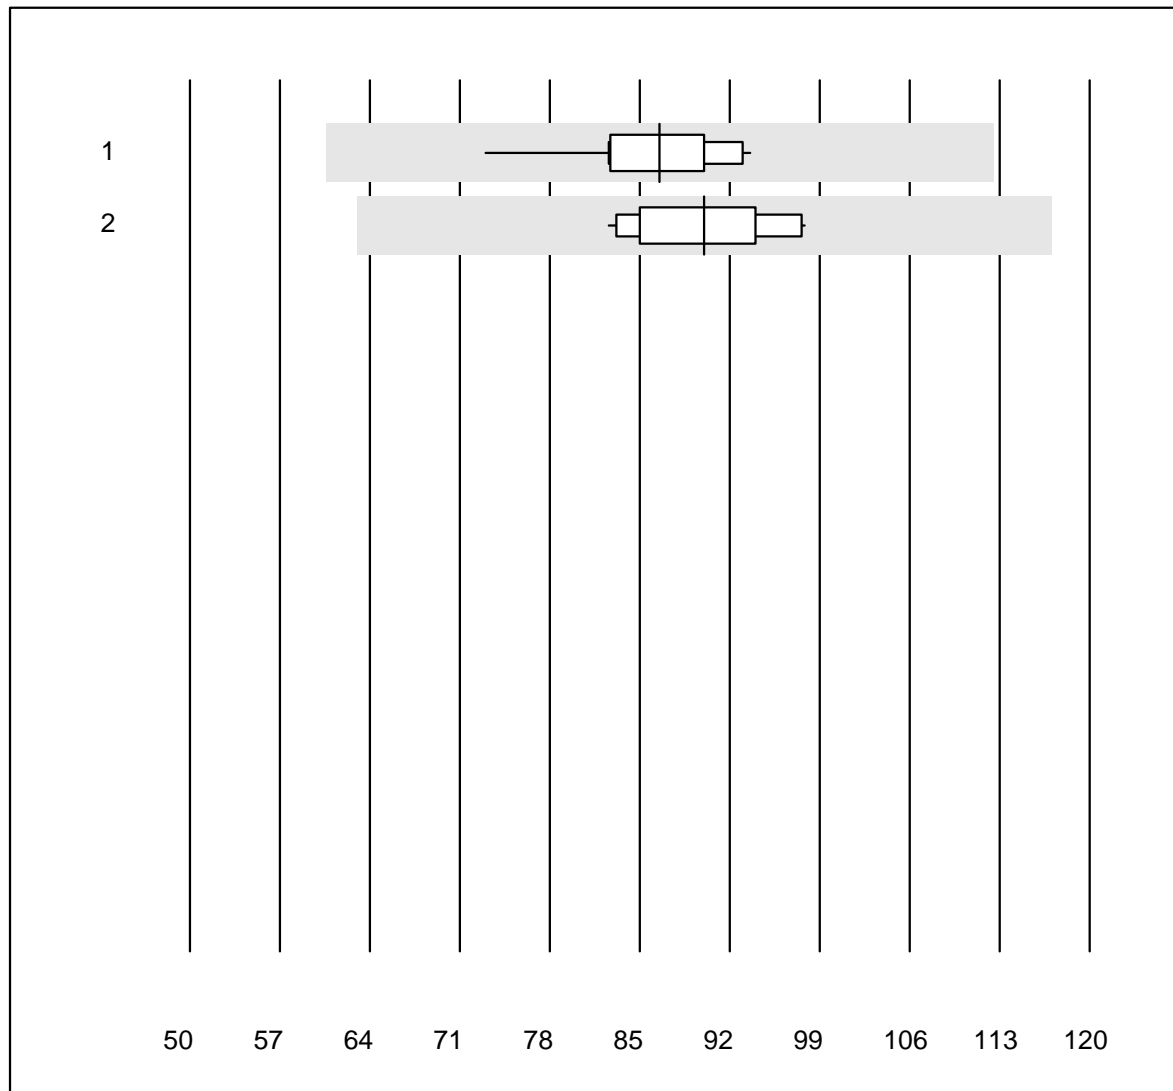


Tolérance MQ : 30 %

Holotranscobalamine (pmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Efulft	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Architect	12	100.0	0.0	0.0	86.5	6.6	e
2	toutes les méthodes	16	93.7	0.0	6.3	90.0	5.6	e

Bilirubin totale Neo

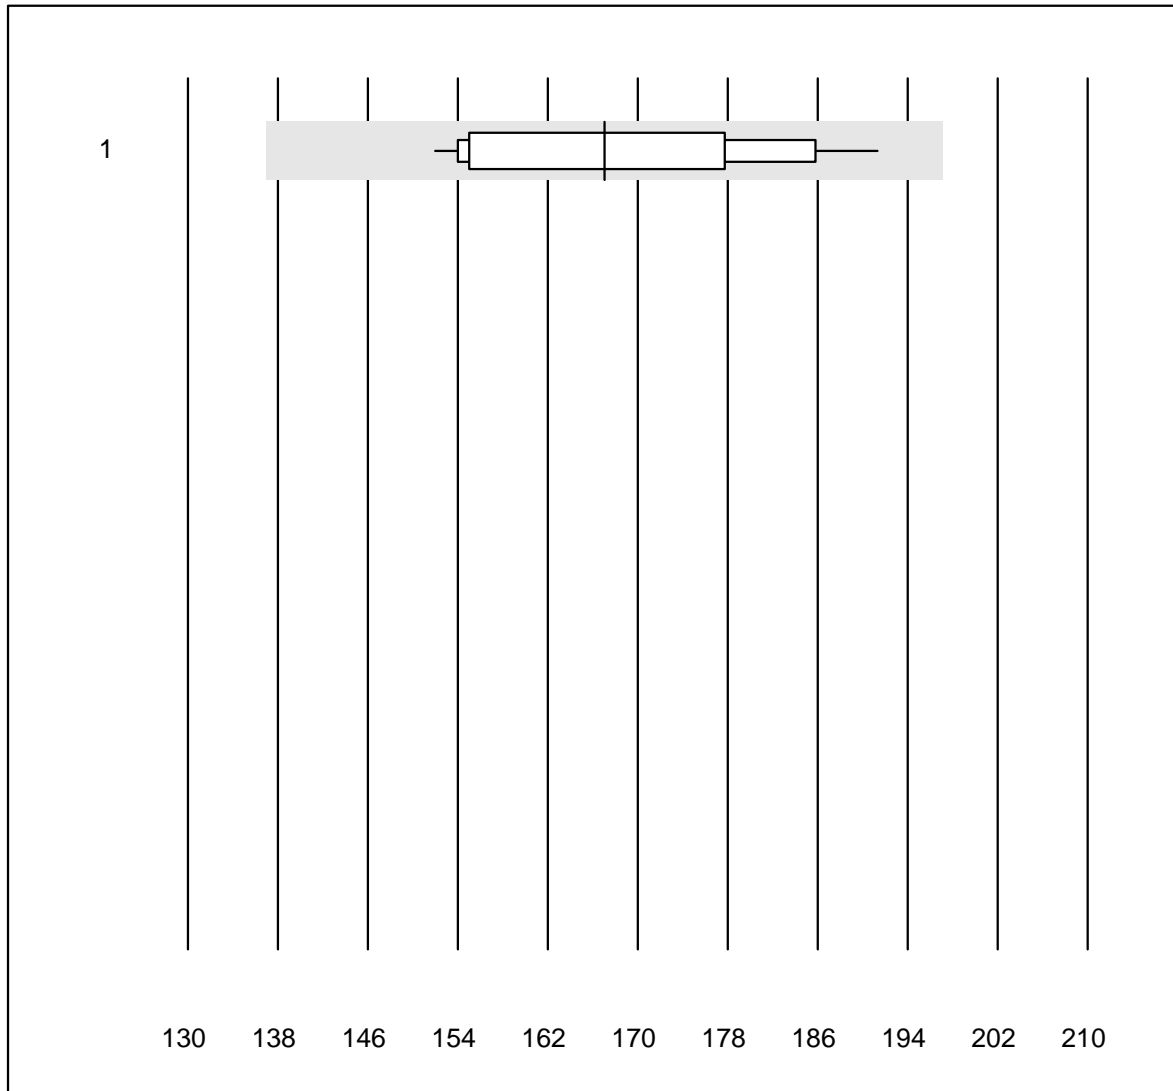


QUALAB Toleranz : 18 %

Bilirubin totale Neo ($\mu\text{mol/l}$)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	16	100.0	0.0	0.0	167	7.4	e

Bilirubin directe

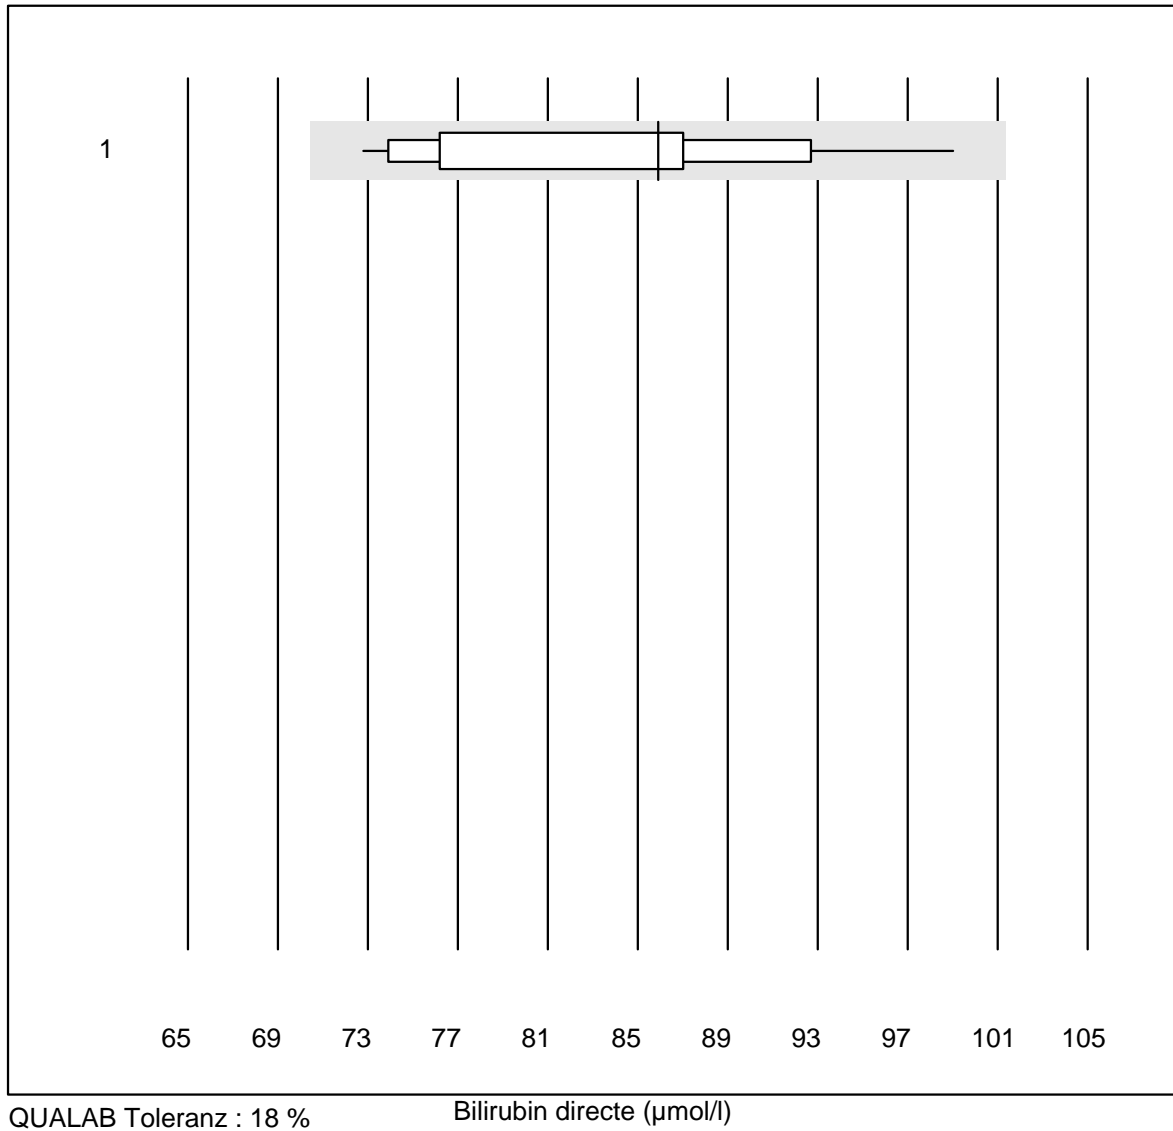


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	14	100.0	0.0	0.0	86	8.8	a

Bilirubin néonatale



Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	9	100.0	0.0	0.0	214	3.3	e
2 ABL700/800	8	100.0	0.0	0.0	190	5.7	e

PSA

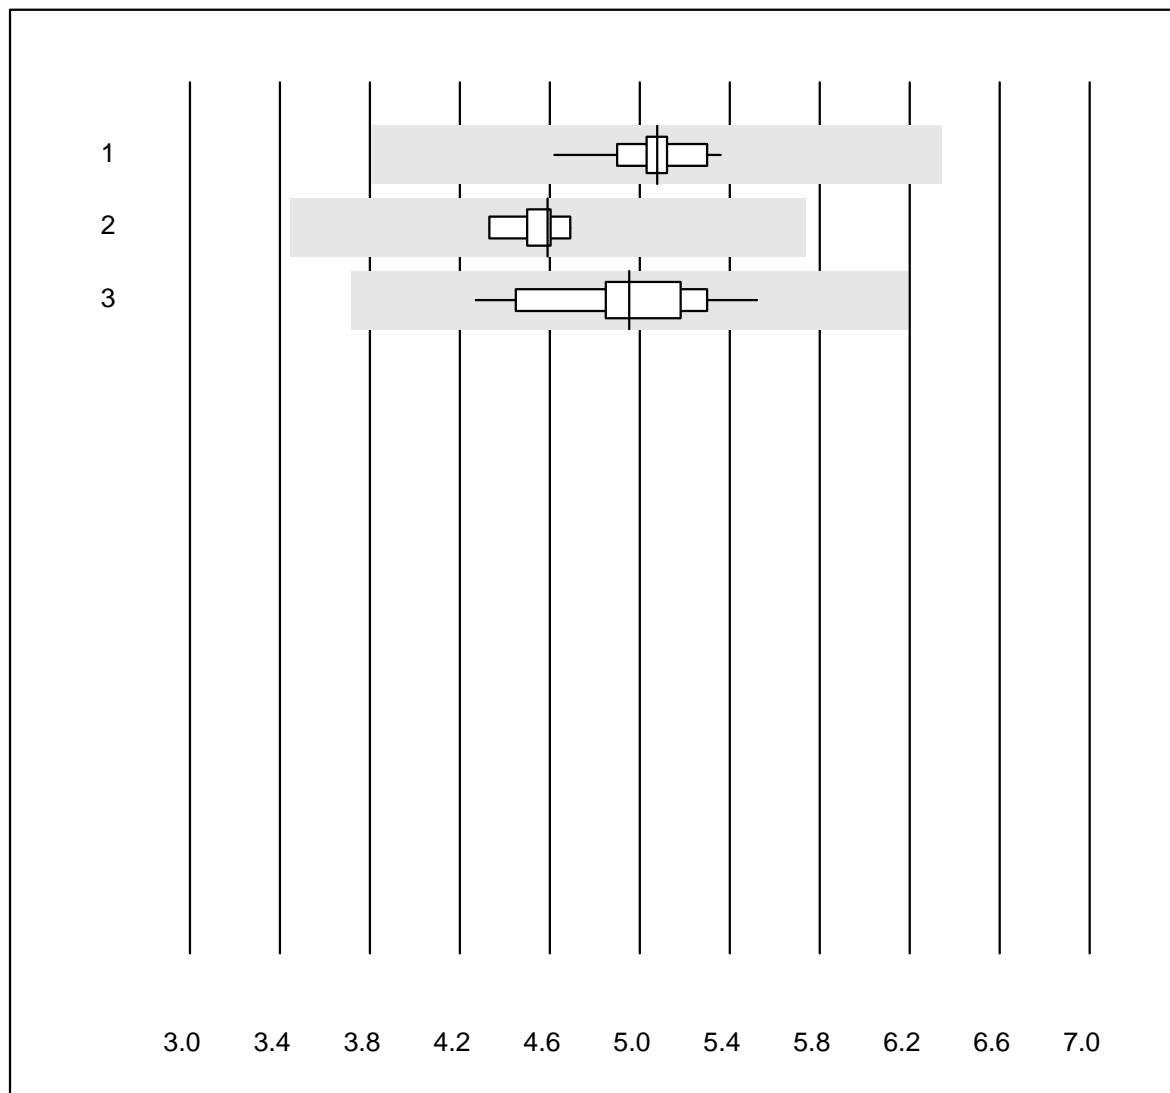


QUALAB Toleranz : 25 %

PSA (µg/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	13	100.0	0.0	0.0	5.08	3.7	e
2 Architect	7	100.0	0.0	0.0	4.59	2.5	e
3 AFIAS	34	100.0	0.0	0.0	4.95	6.2	e

PSA frei

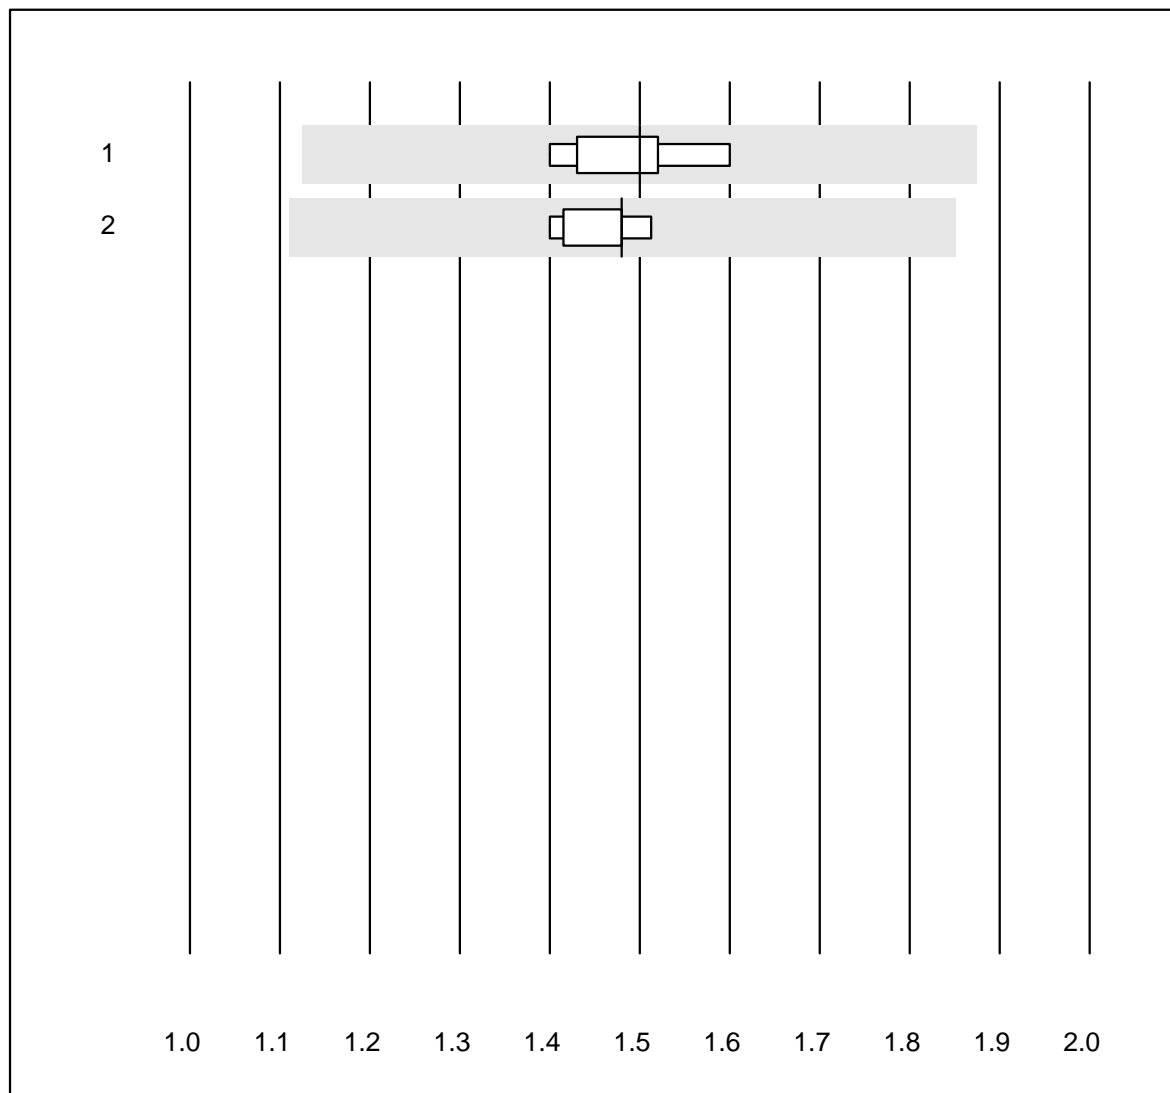


QUALAB Toleranz : 25 %

PSA frei (µg/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	8	100.0	0.0	0.0	1.50	4.1	e
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	1.48	3.3	e

CEA

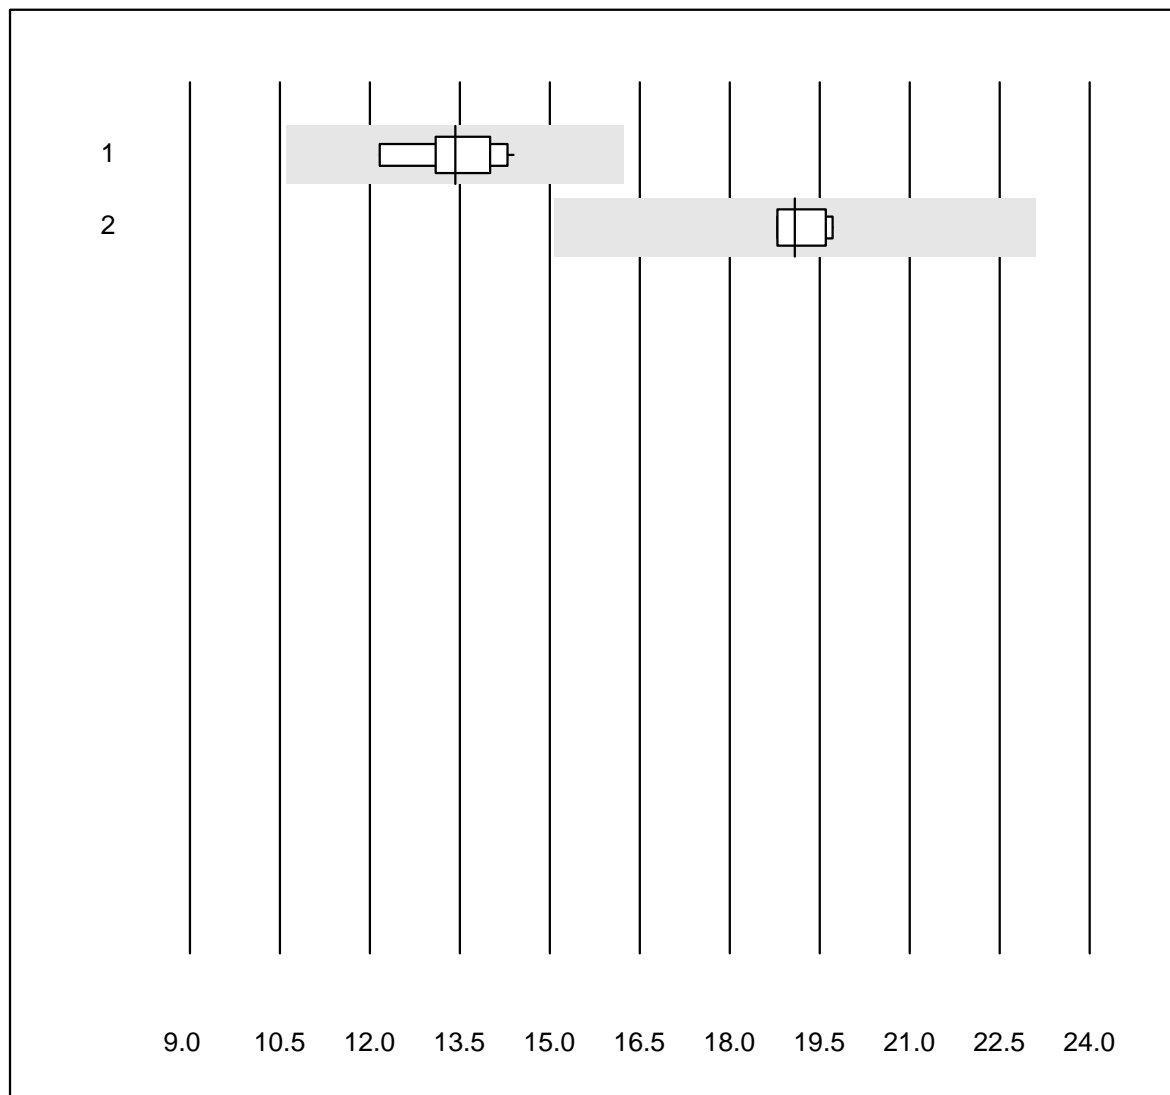


QUALAB Toleranz : 21 %

CEA (µg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	10	100.0	0.0	0.0	13.4	5.6	e
2	Architect	6	100.0	0.0	0.0	19.1	2.1	e

CA 125

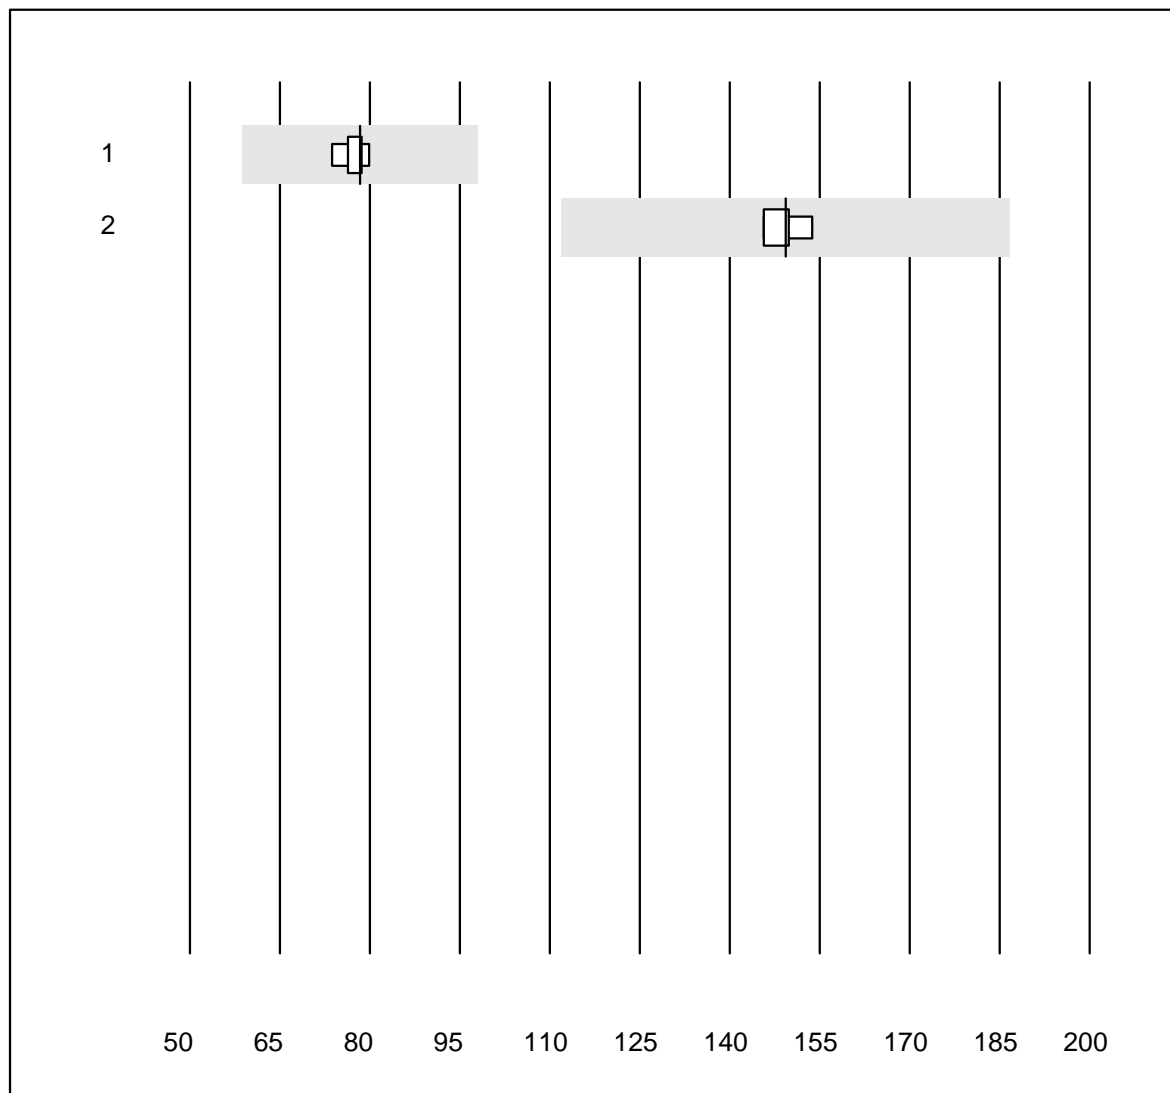


Tolérance MQ : 25 %

CA 125 (kIU/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	5	100.0	0.0	0.0	78.4	3.1	e
2	Architect	4	100.0	0.0	0.0	149.3	2.2	e

CA 19-9

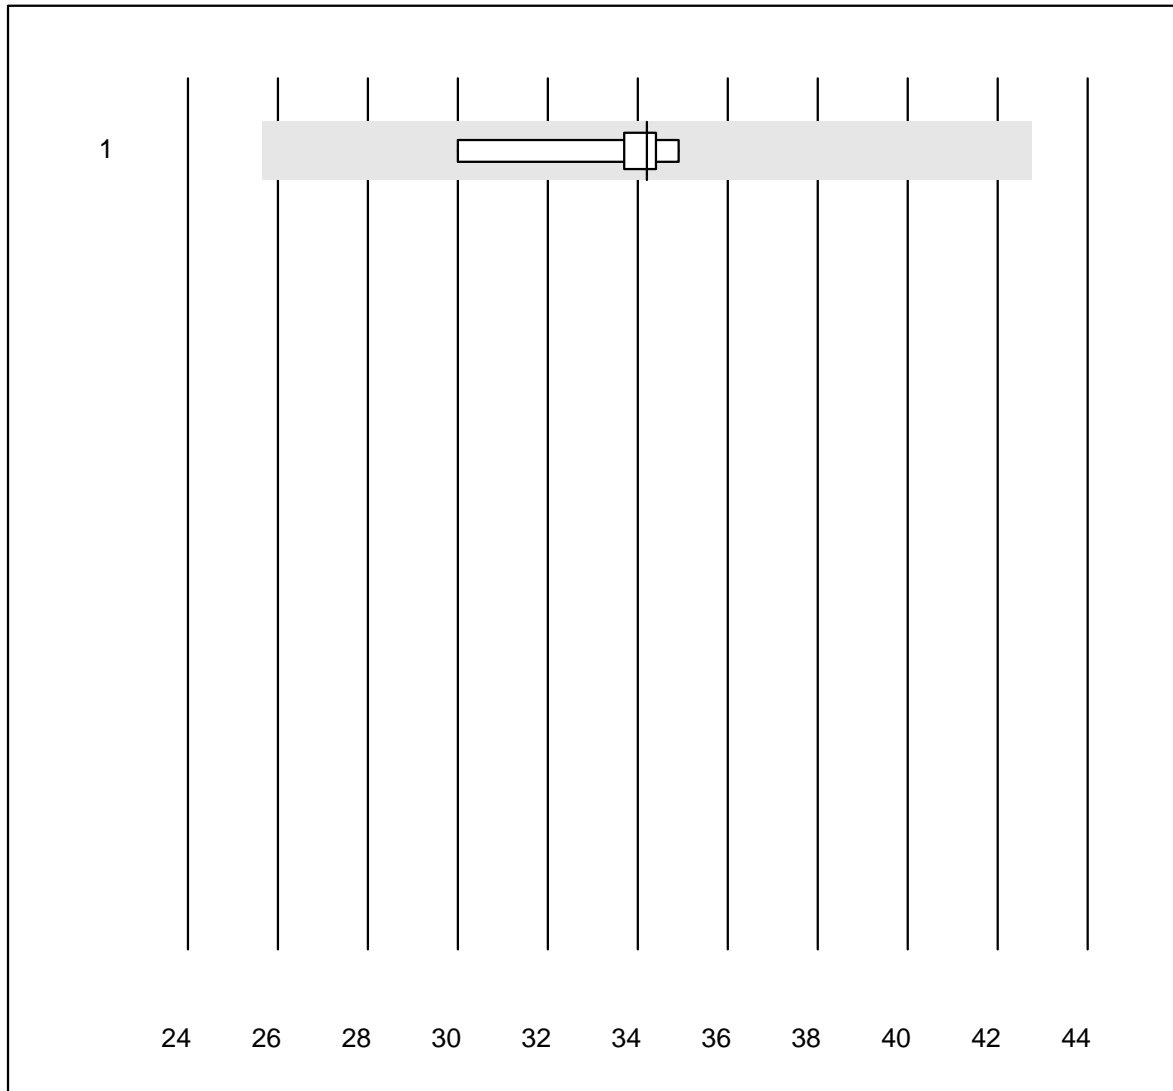


Tolérance MQ : 25 %

CA 19-9 (kIU/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	5	100.0	0.0	0.0	34.2	5.9	e

CA 15-3

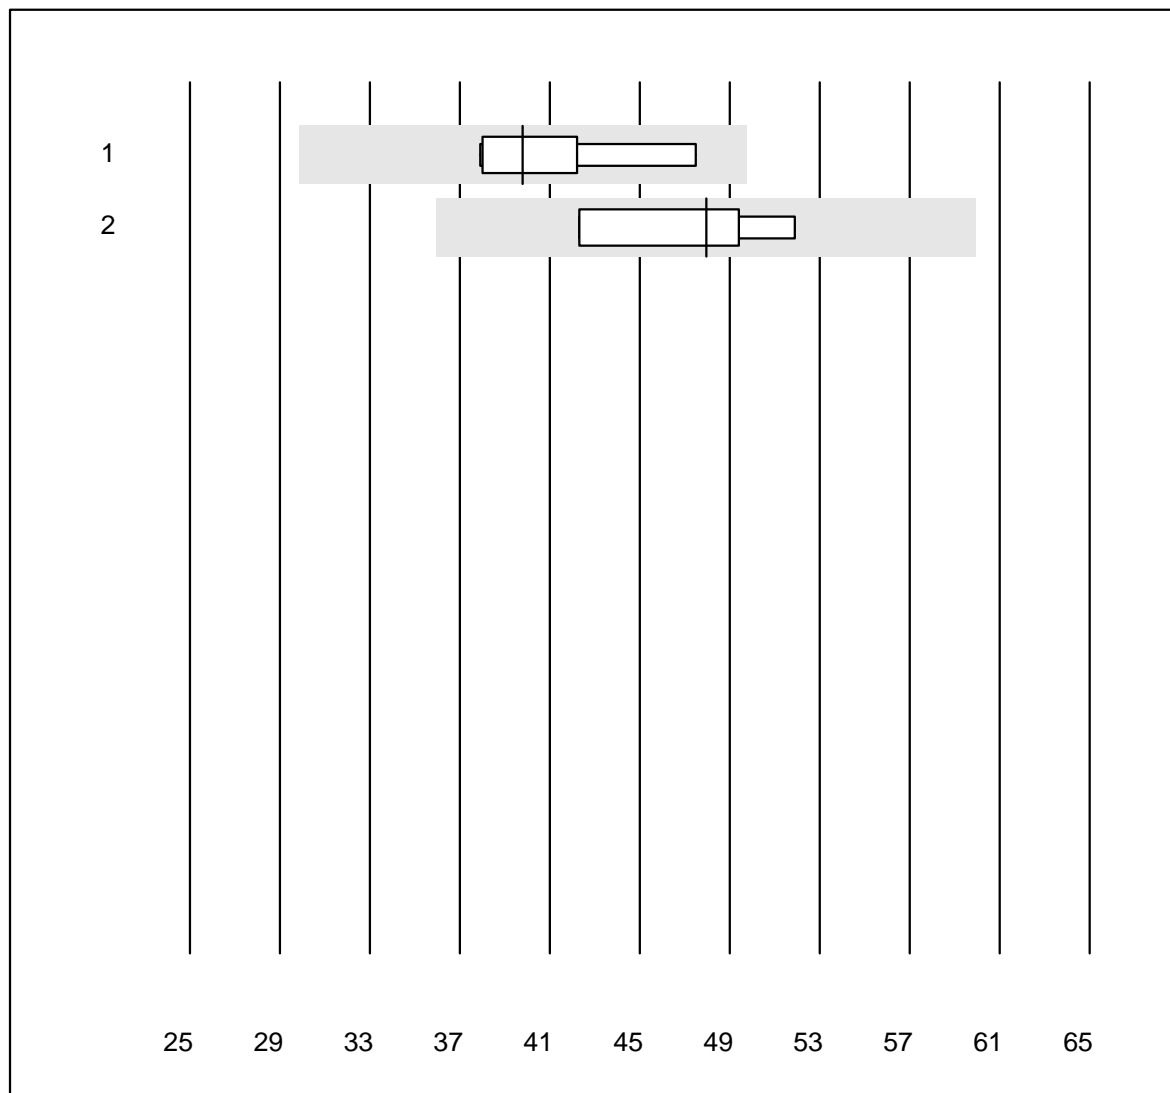


Tolérance MQ : 25 %

CA 15-3 (kIU/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	6	100.0	0.0	0.0	39.8	8.9	e*
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	48.0	8.7	e*

AFP

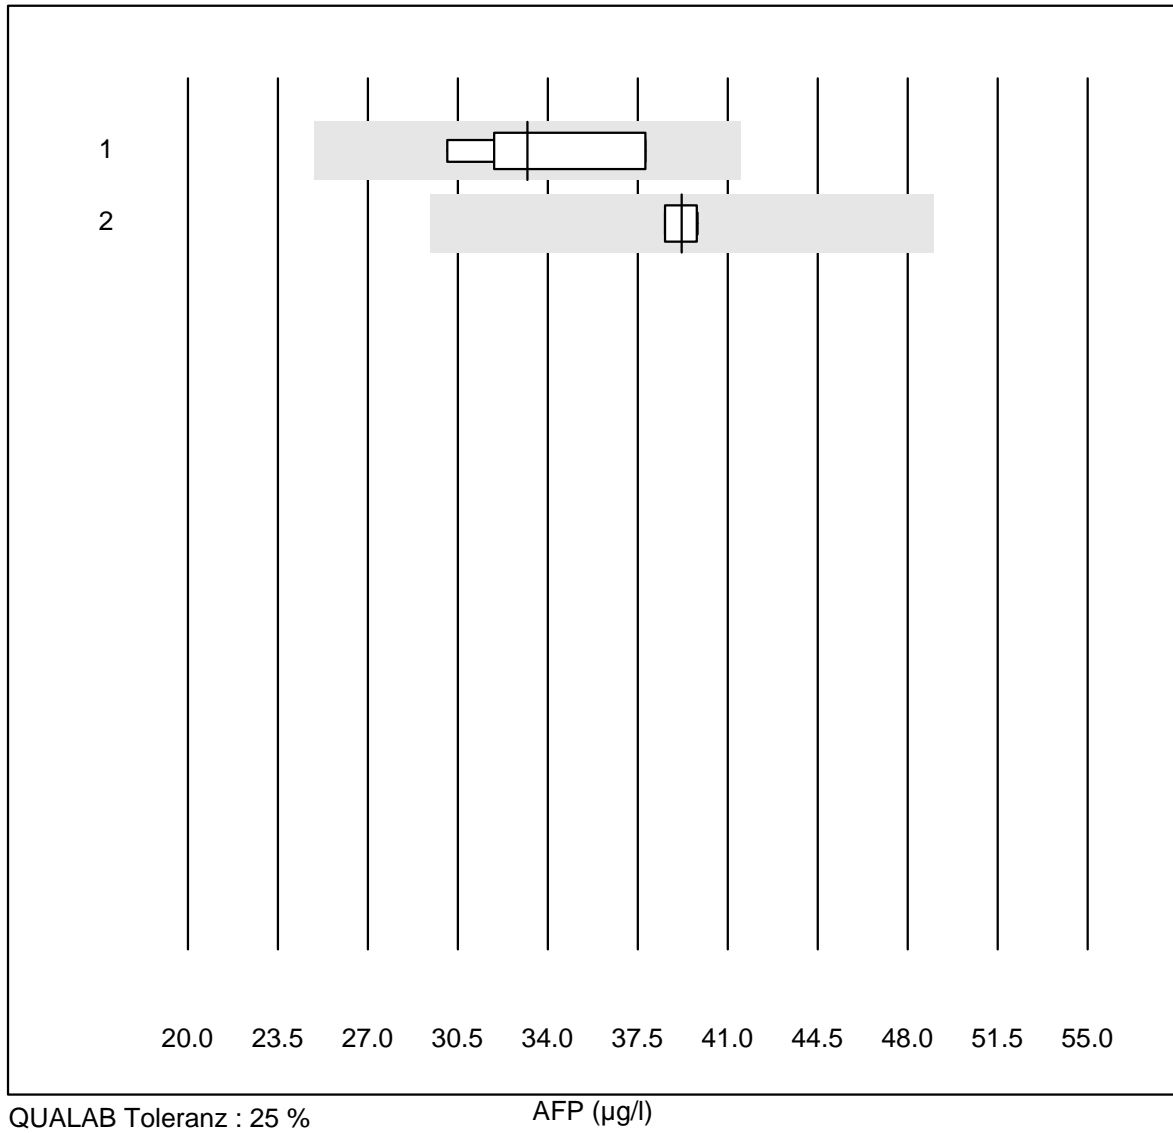


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas E / Elecsys	5	100.0	0.0	0.0	33.2	10.2	e*
2	Architect	4	100.0	0.0	0.0	39.2	1.8	e

HCG qn

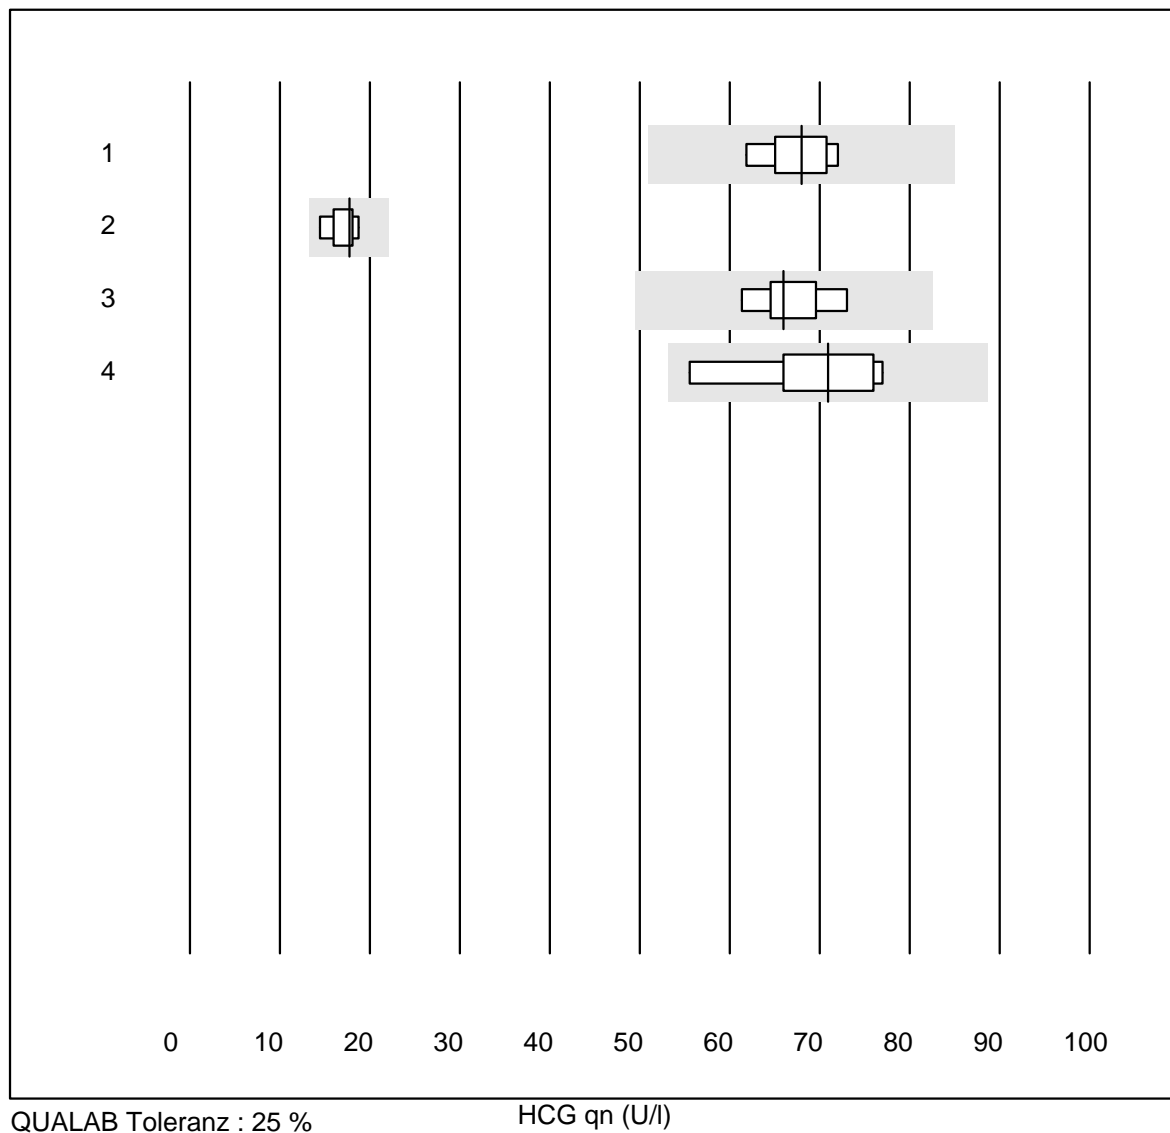

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas E / Elecsys	9	100.0	0.0	0.0	68.0	5.5	e
2 VIDAS	8	100.0	0.0	0.0	17.7	8.3	e
3 Architect	7	100.0	0.0	0.0	66.0	5.7	e
4 AFIAS	7	100.0	0.0	0.0	70.9	10.4	e*

CK-MB

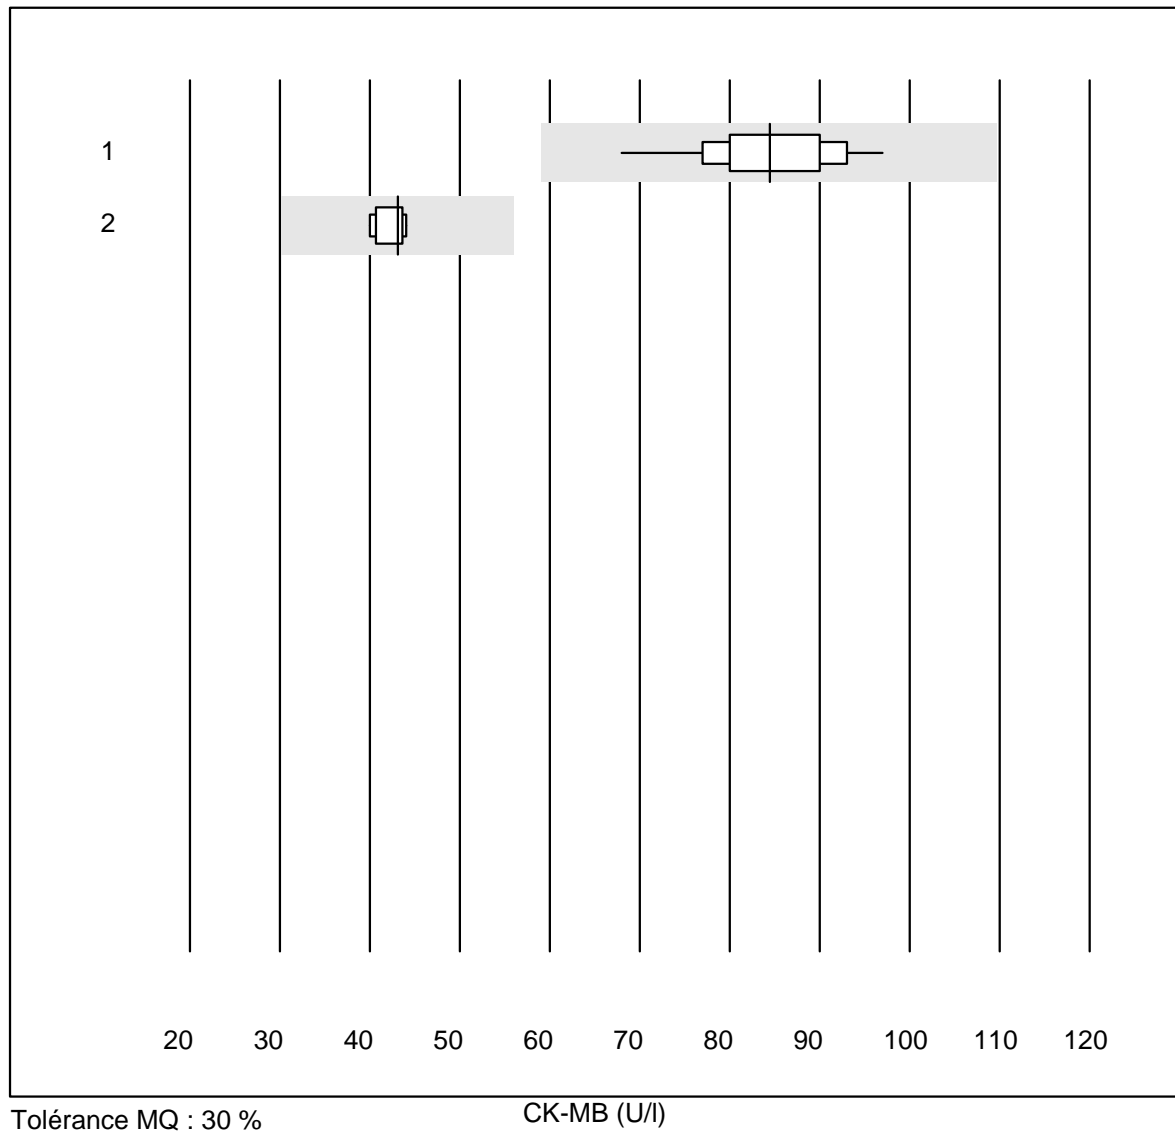


Tolérance MQ : 30 %

CK-MB (U/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Fuji Dri-Chem	27	96.3	0.0	3.7	84.4	7.7	e
2	Cobas/Roche	7	100.0	0.0	0.0	43.1	3.7	e

BNP

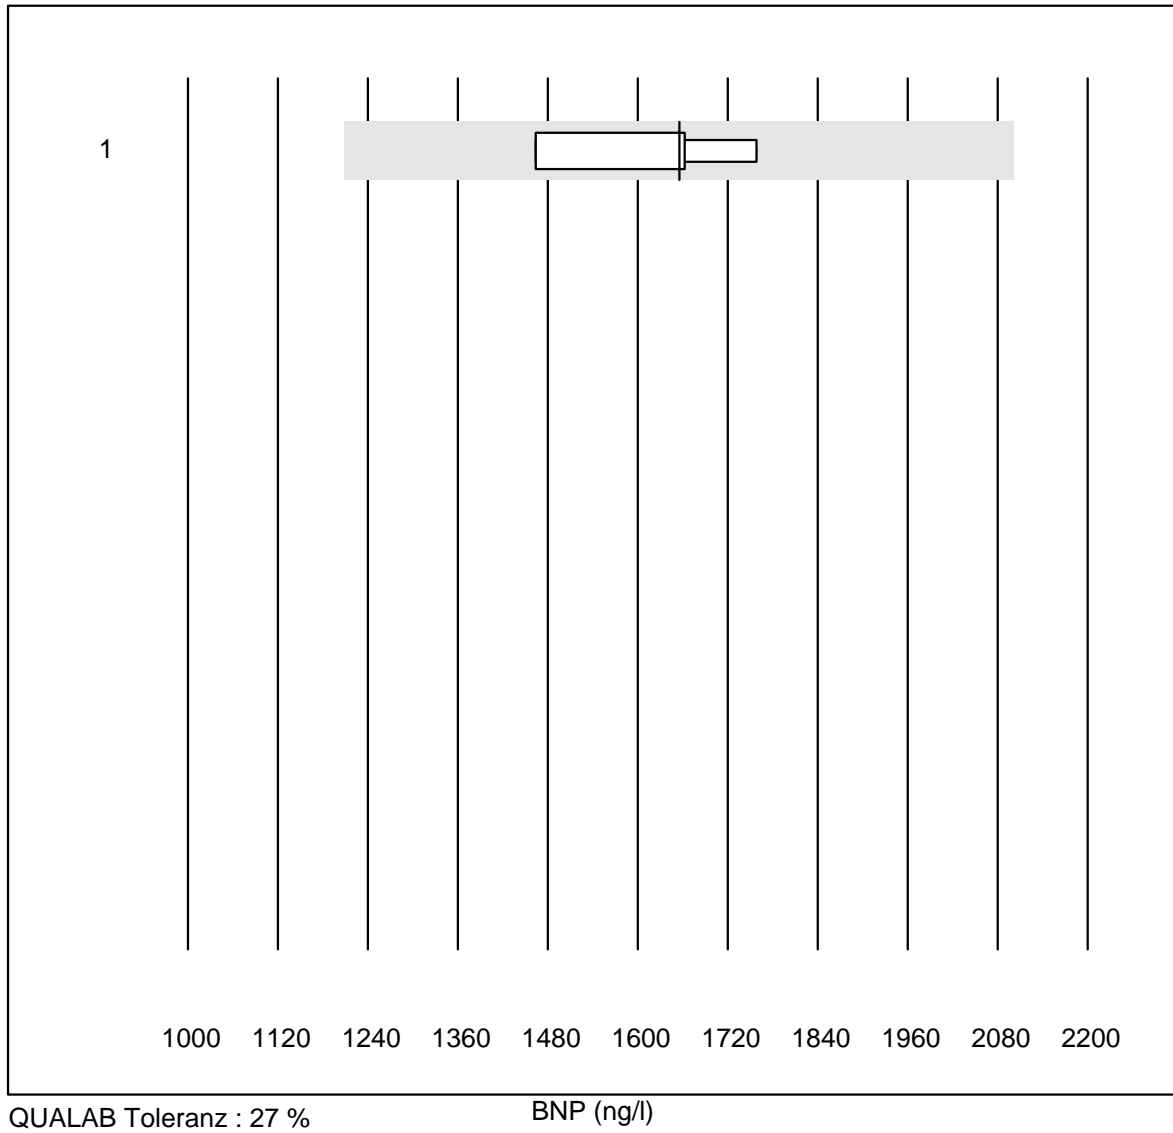

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Architect	4	100.0	0.0	0.0	1655.2	7.5	e*

Cholésterol PTS

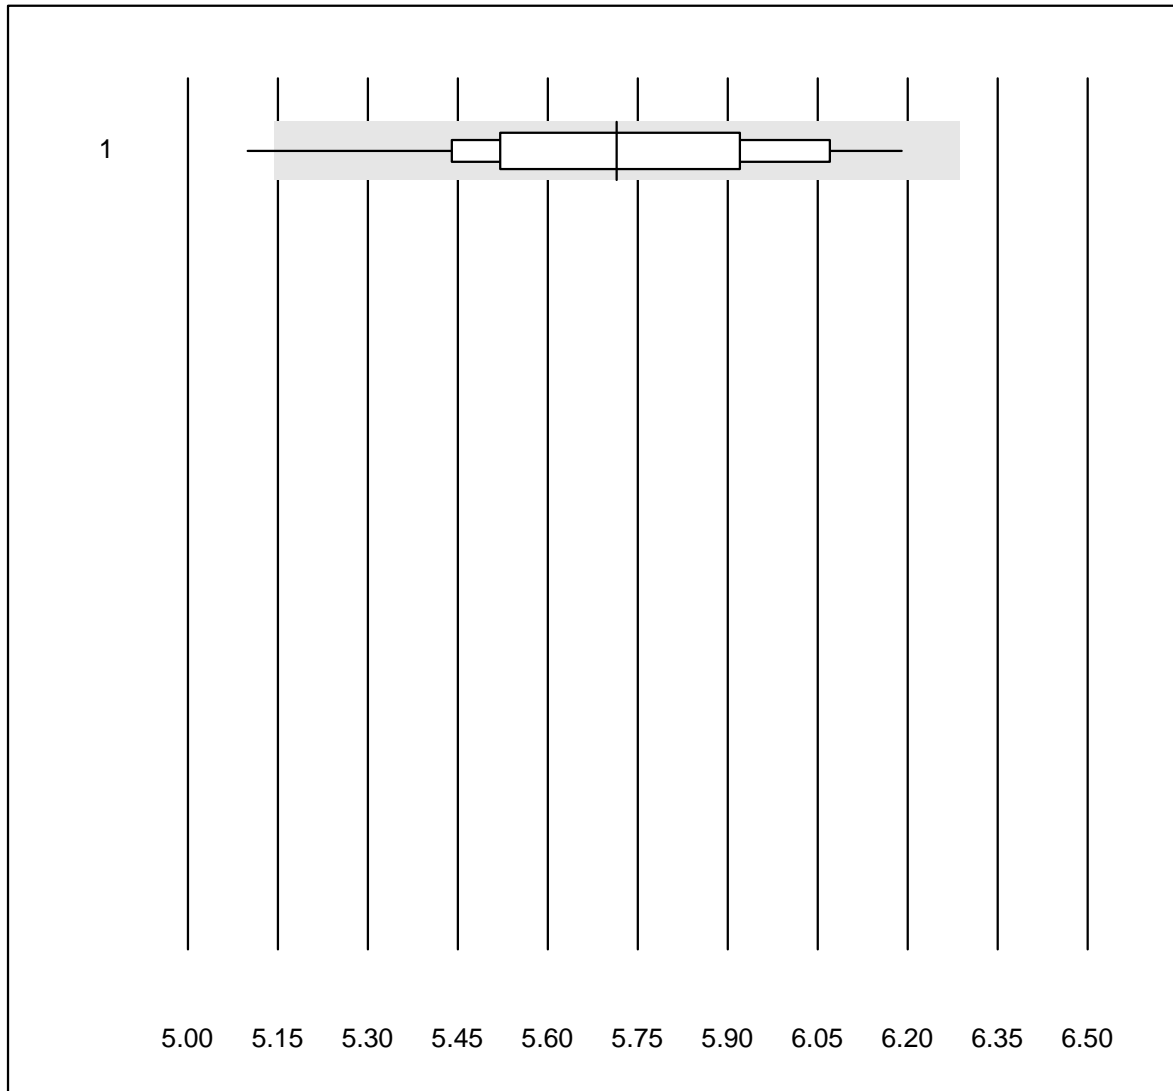


QUALAB Toleranz : 10 %

Cholésterol PTS (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 CardioChek	13	84.6	7.7	7.7	5.72	5.4	e*

Cholésterol HDL PTS

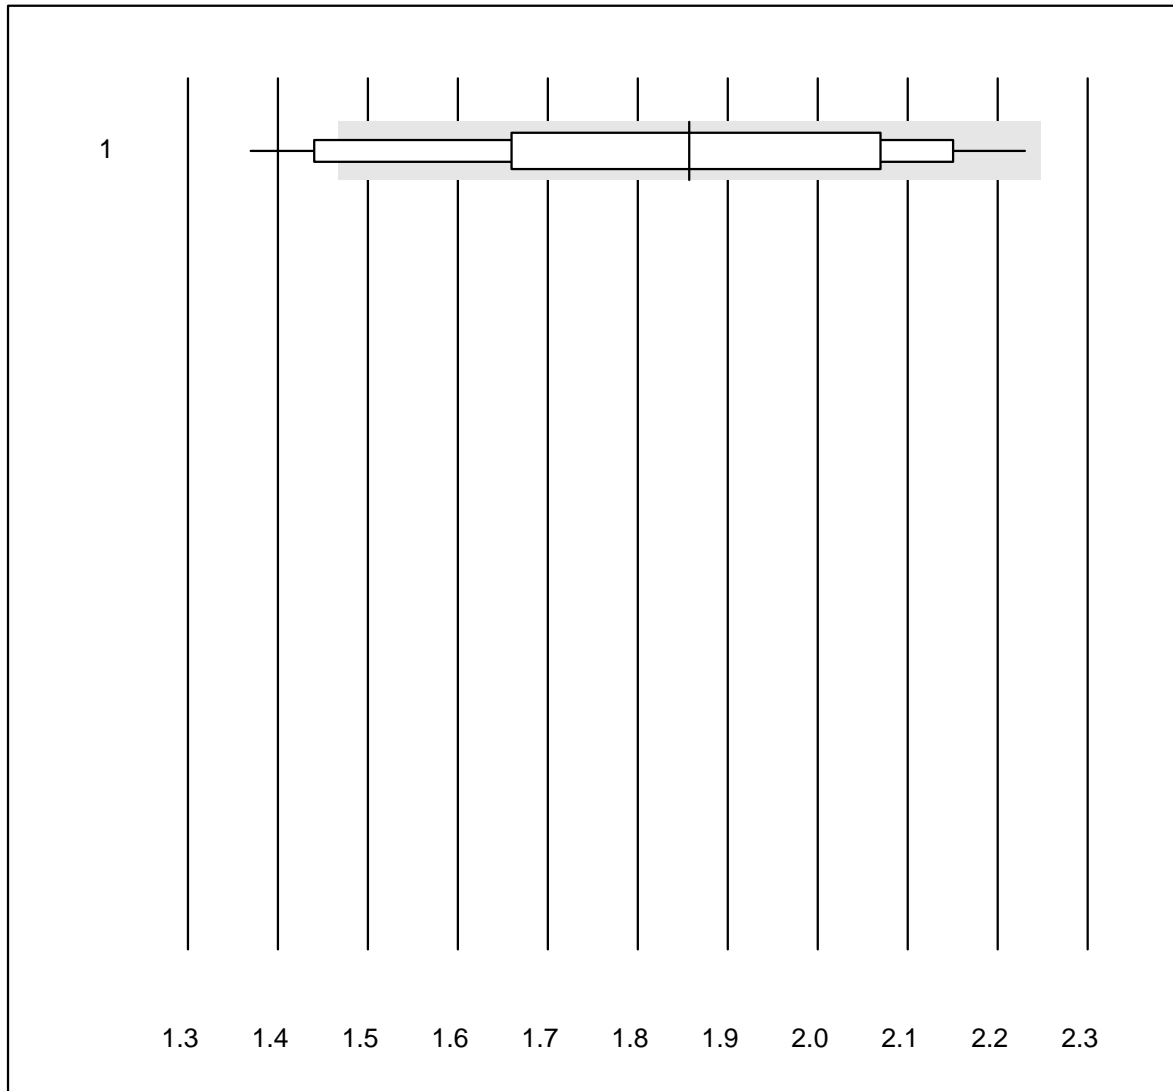


QUALAB Toleranz : 21 %

Cholésterol HDL PTS (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 CardioChek	12	83.3	16.7	0.0	1.86	15.1	e*

Triglycérides PTS

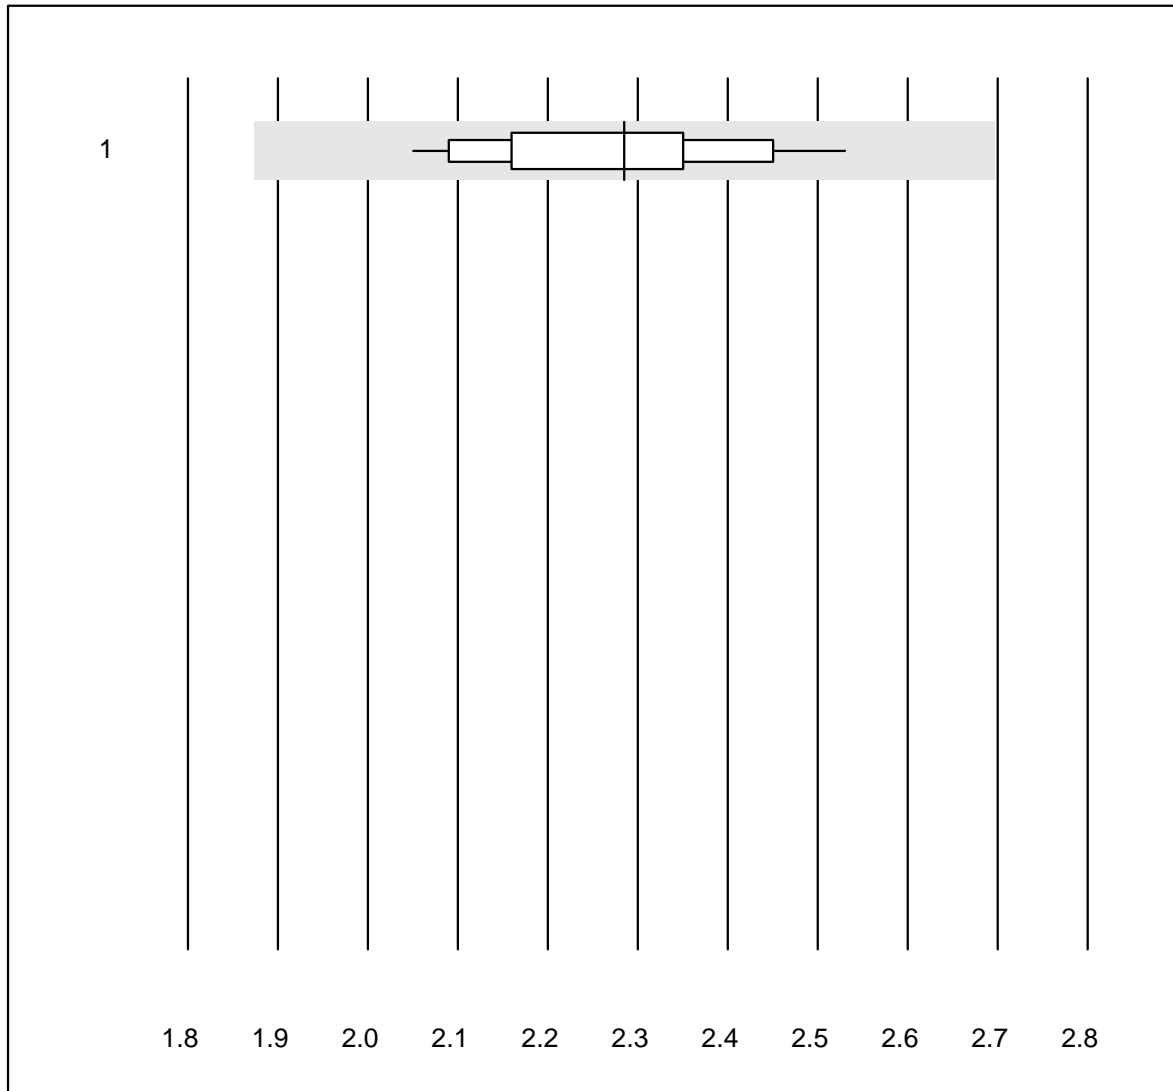


QUALAB Toleranz : 18 %

Triglycérides PTS (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	CardioChek	12	100.0	0.0	0.0	2.29	6.3	e


C-Peptid

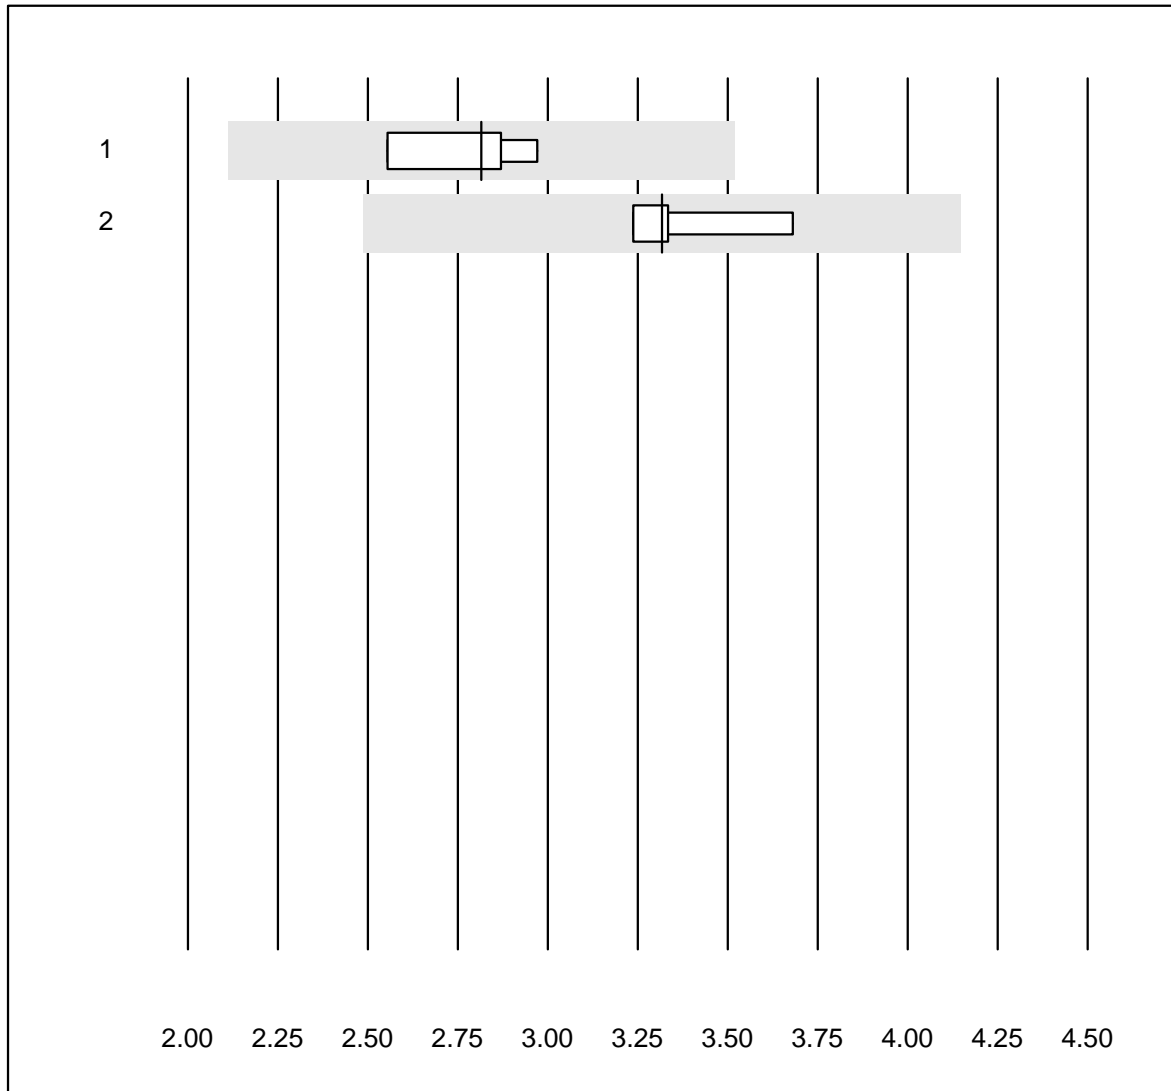

Tolérance MQ : 25 %


C-Peptid (nmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	2.81	6.4	e*
2	Liaison	4	100.0	0.0	0.0	3.32	5.9	e

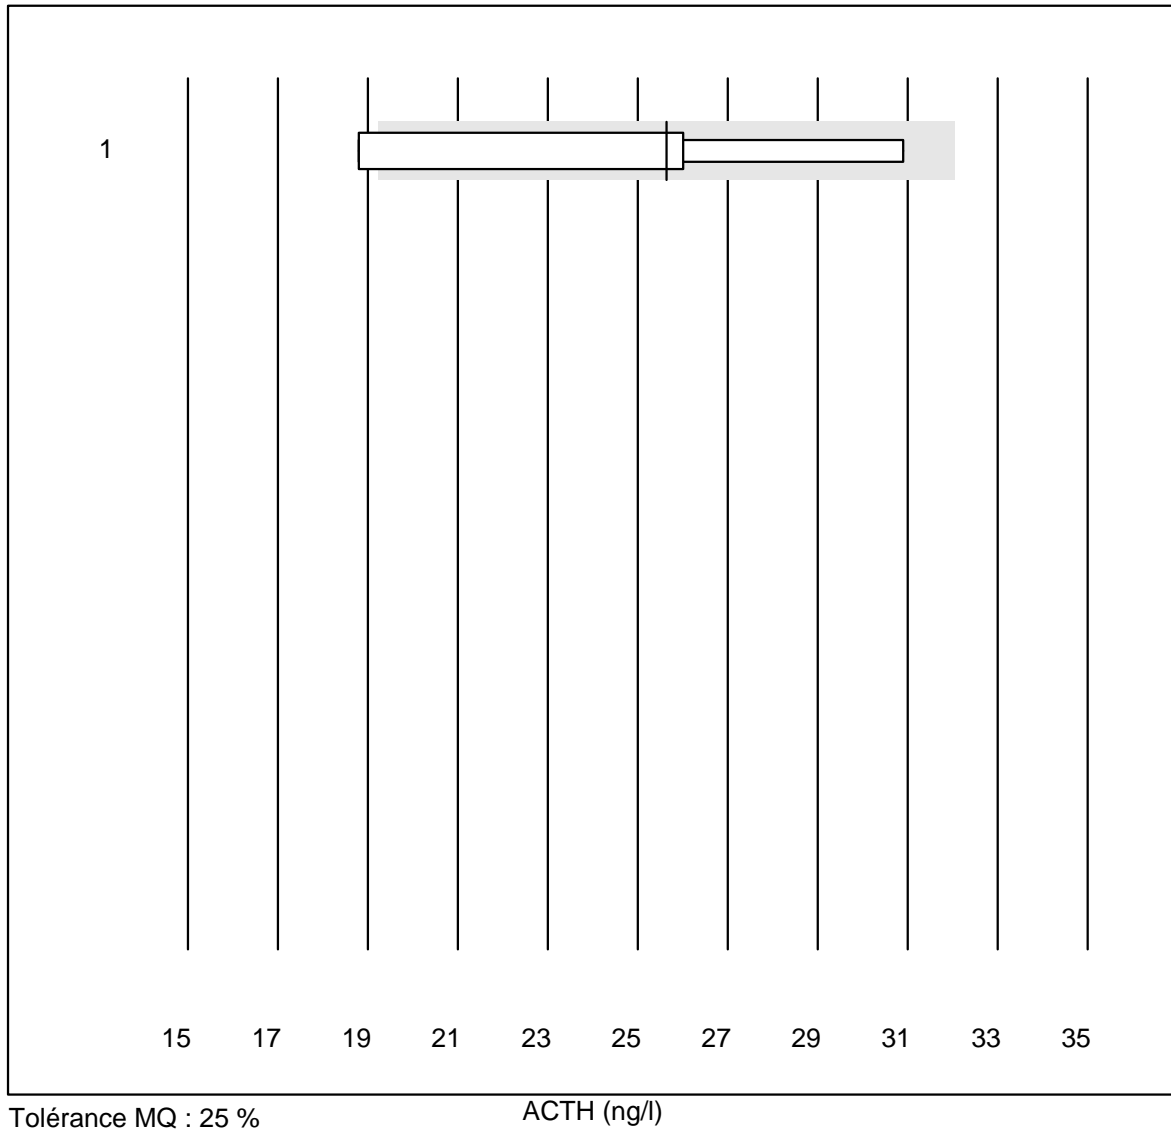ACTH


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Liaison	4	75.0	25.0	0.0	25.64	19.7	e*

Procalcitonine

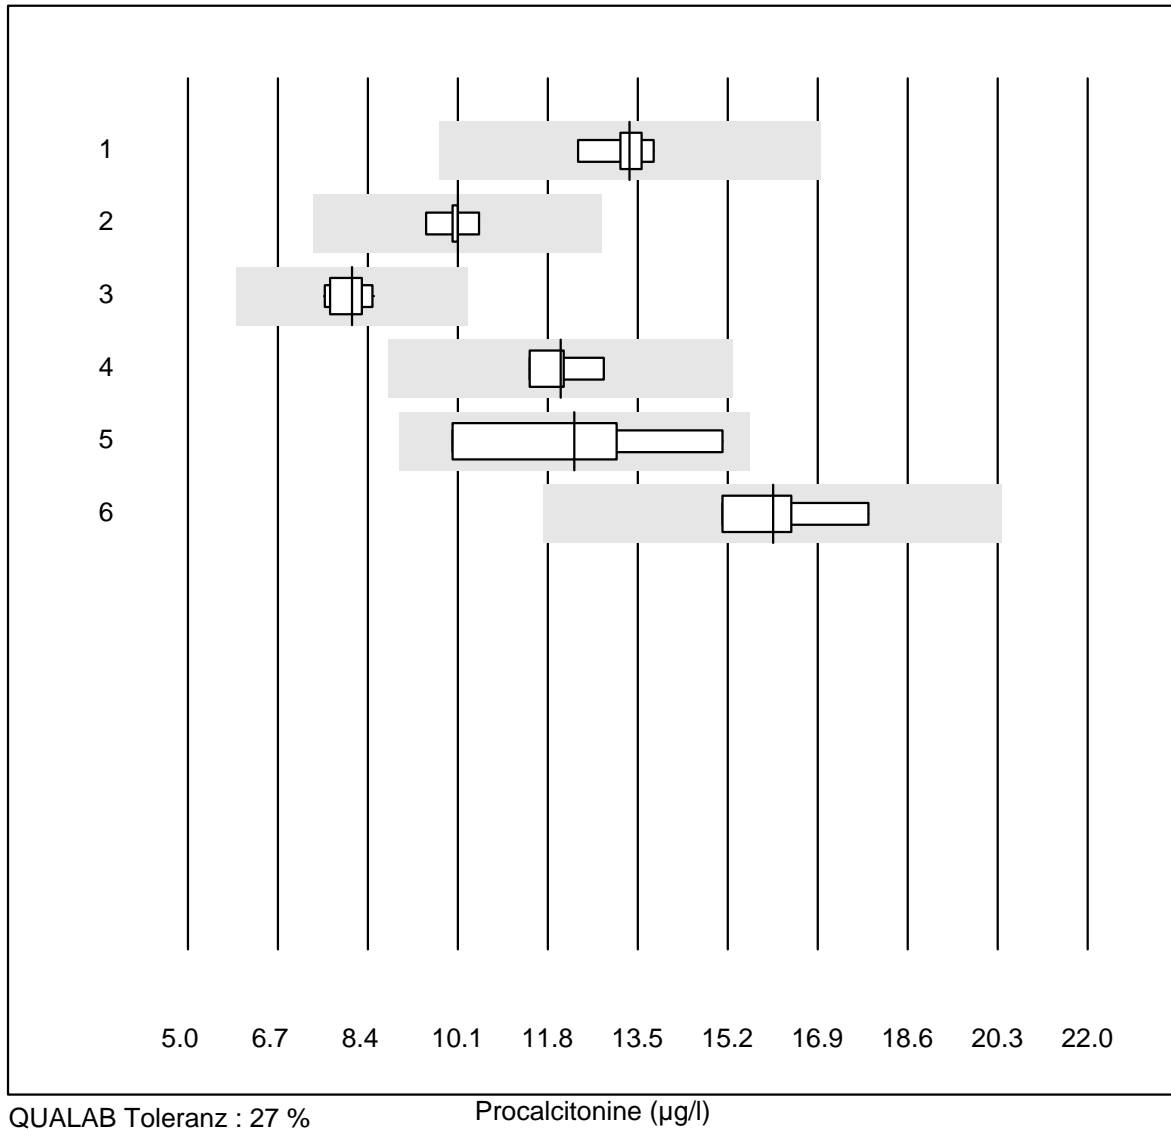

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Architect	6	100.0	0.0	0.0	13.34	3.7	e
2 Cobas	9	100.0	0.0	0.0	10.10	2.8	e
3 VIDAS	11	100.0	0.0	0.0	8.09	4.2	e
4 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	12.04	4.7	e
5 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	12.30	17.6	e*
6 Liaison	4	100.0	0.0	0.0	16.05	7.3	e*

EPO

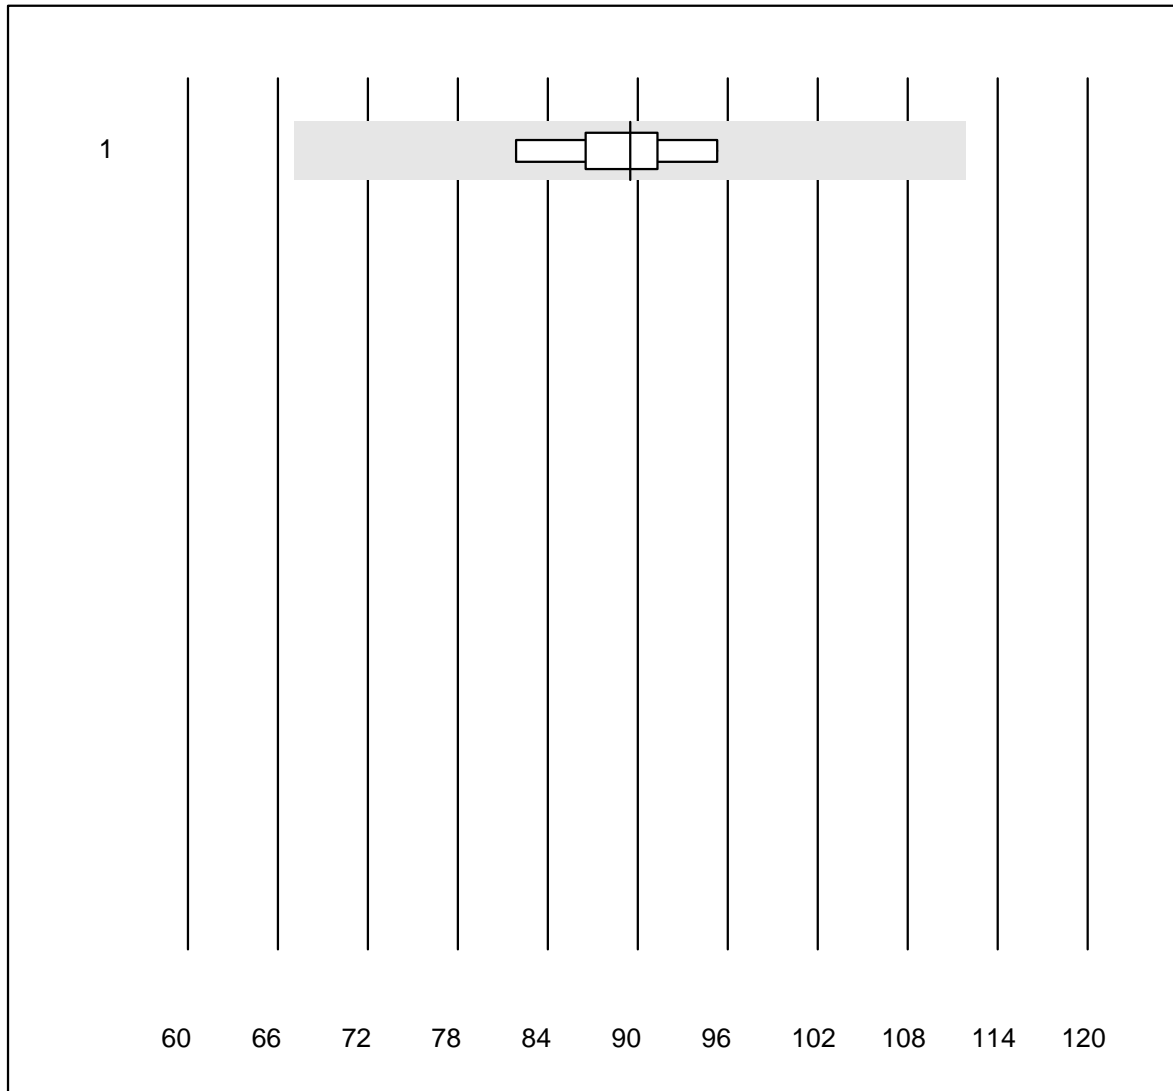


Tolérance MQ : 25 %

EPO (U/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Immulite	5	100.0	0.0	0.0	89.5	5.7	e

Parathormone

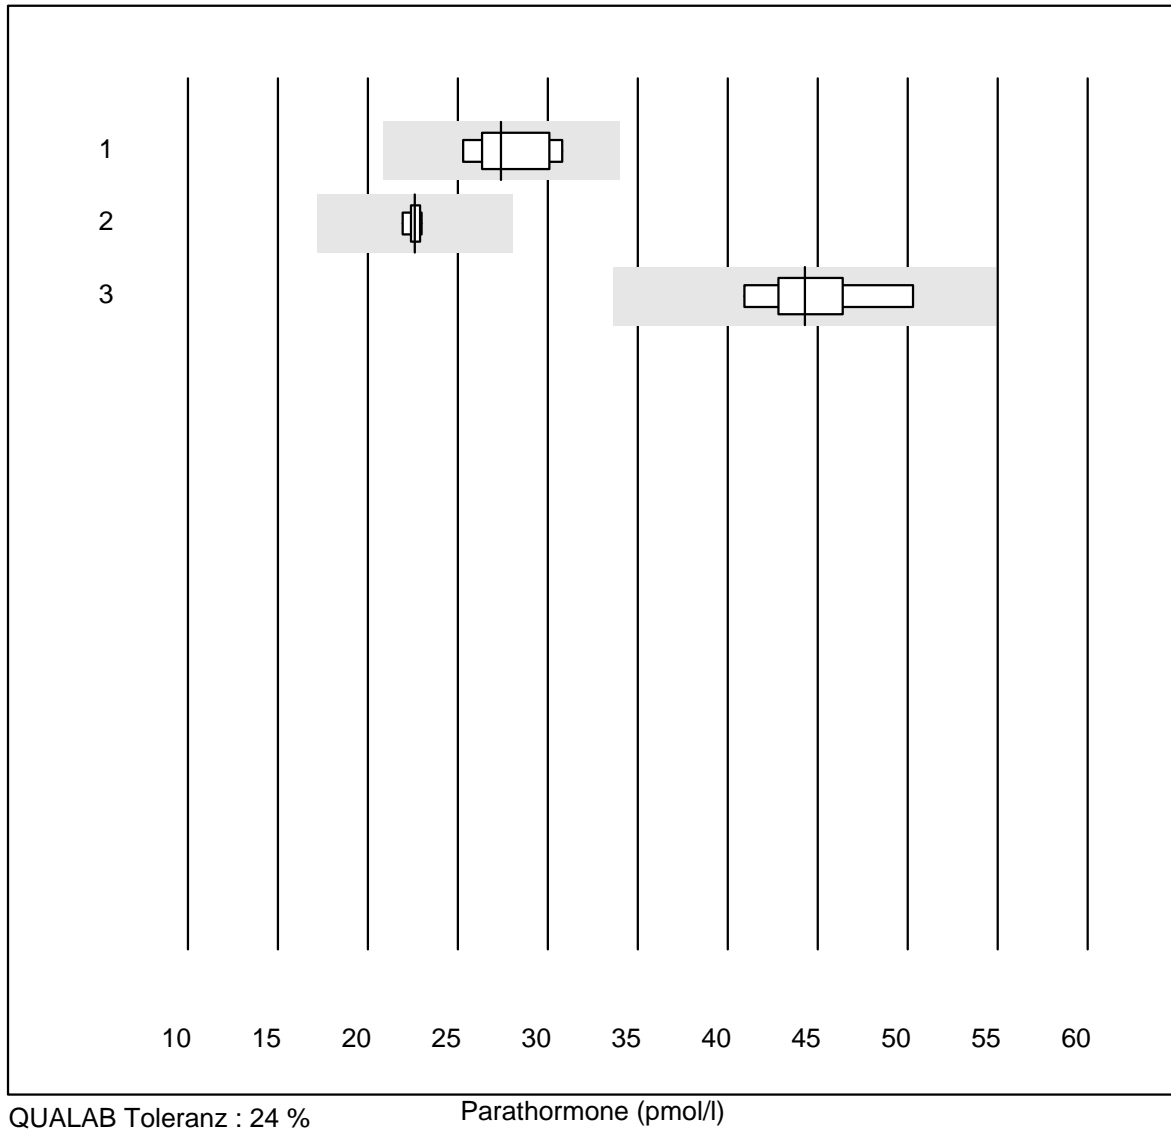


Nr.	Method	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas PTH STAT	7	100.0	0.0	0.0	27.4	7.4	e
2	Cobas	6	100.0	0.0	0.0	22.6	1.7	e
3	Architect	5	100.0	0.0	0.0	44.3	8.0	e*

Osmolalität

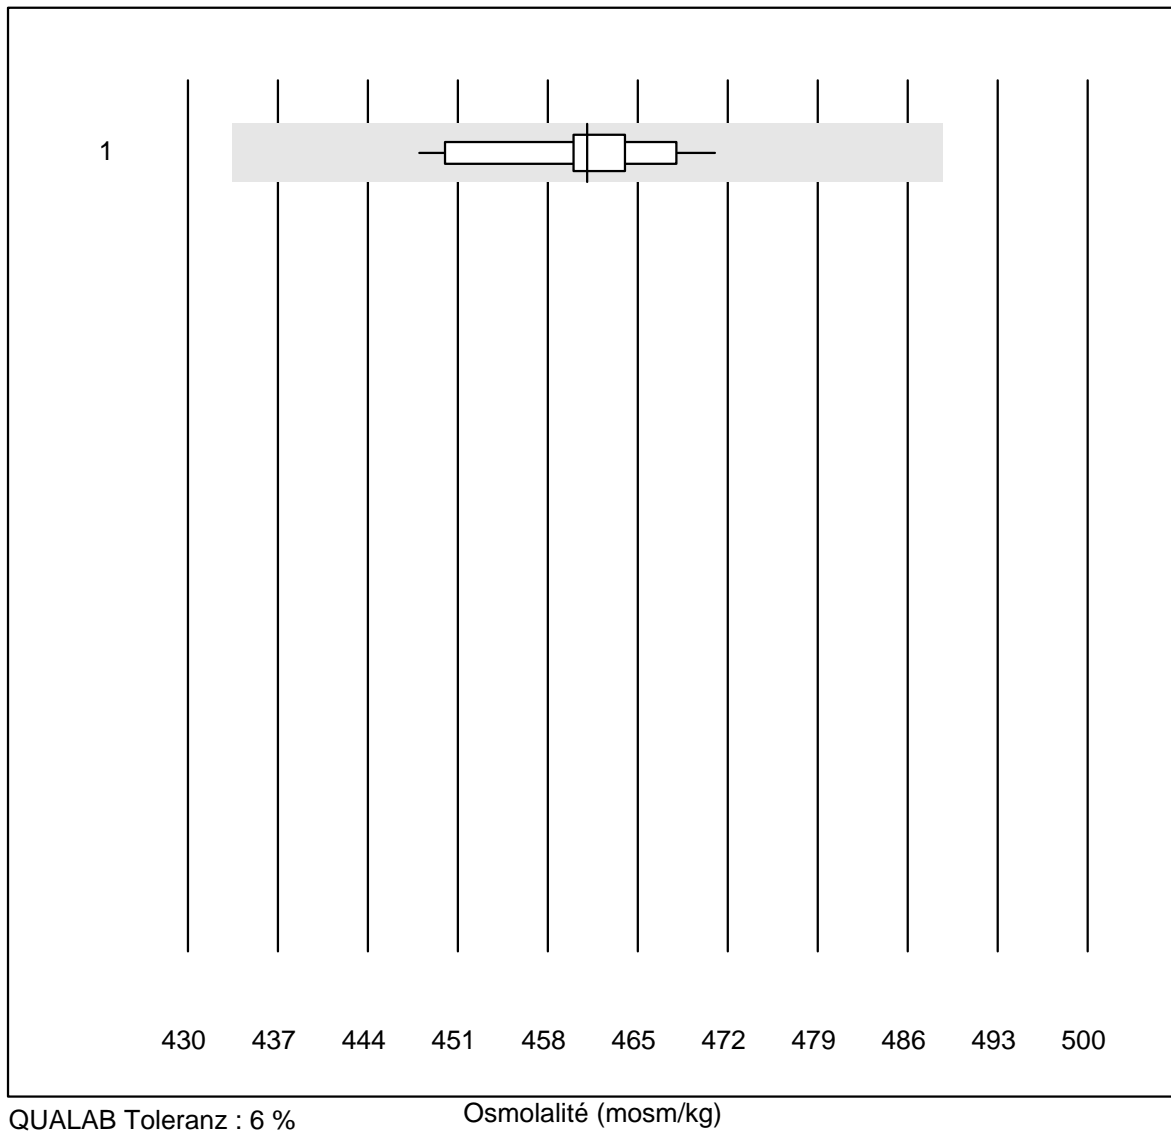


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cryoscopie	15	100.0	0.0	0.0	461	1.3	e

Kalium-K22

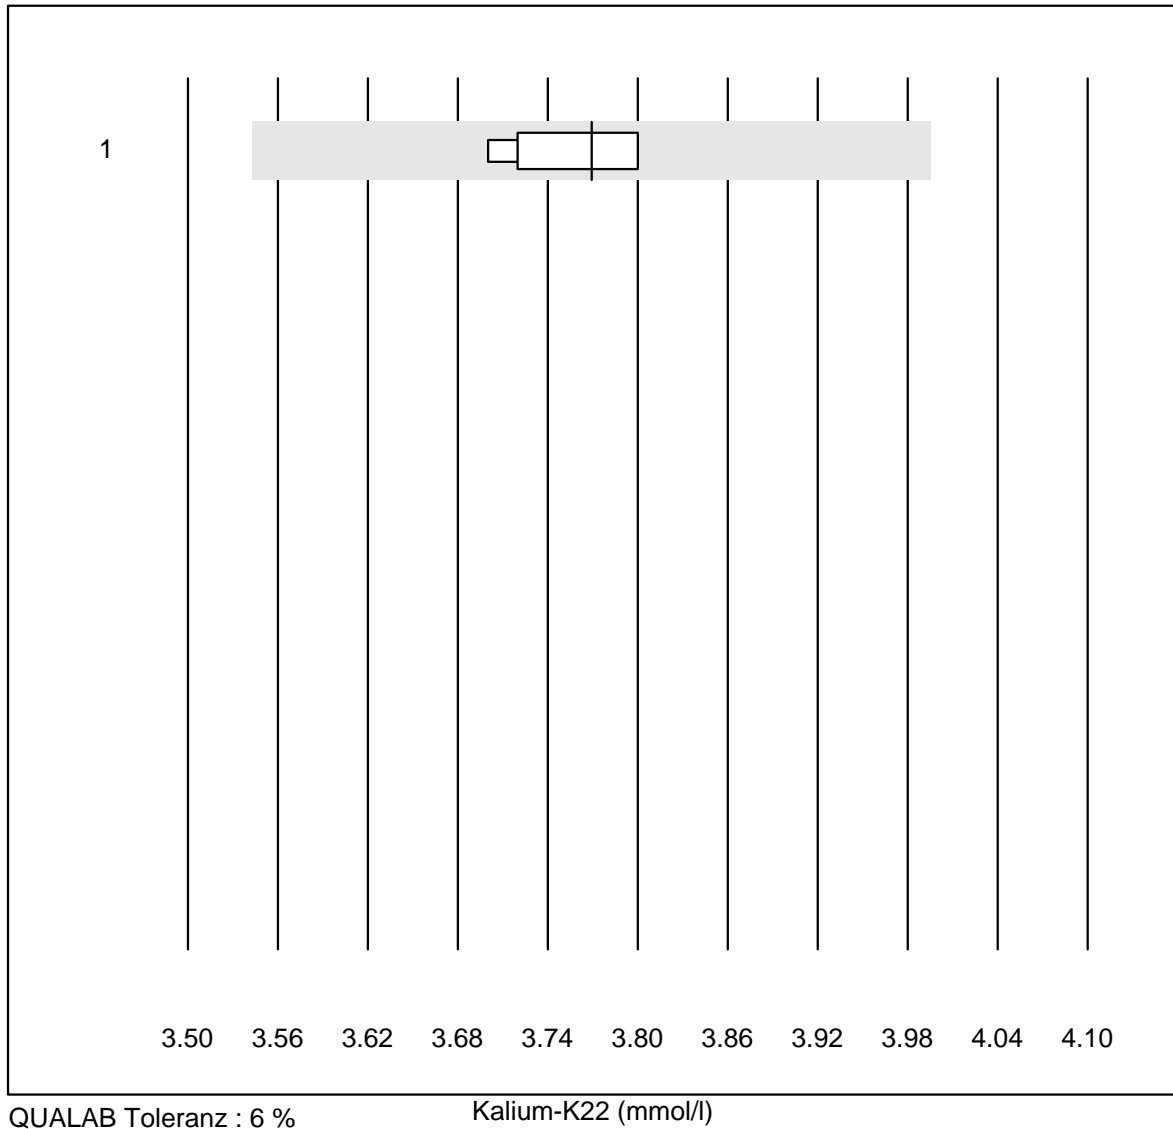

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 ISE	11	100.0	0.0	0.0	3.8	1.1	e

Natrium-K22

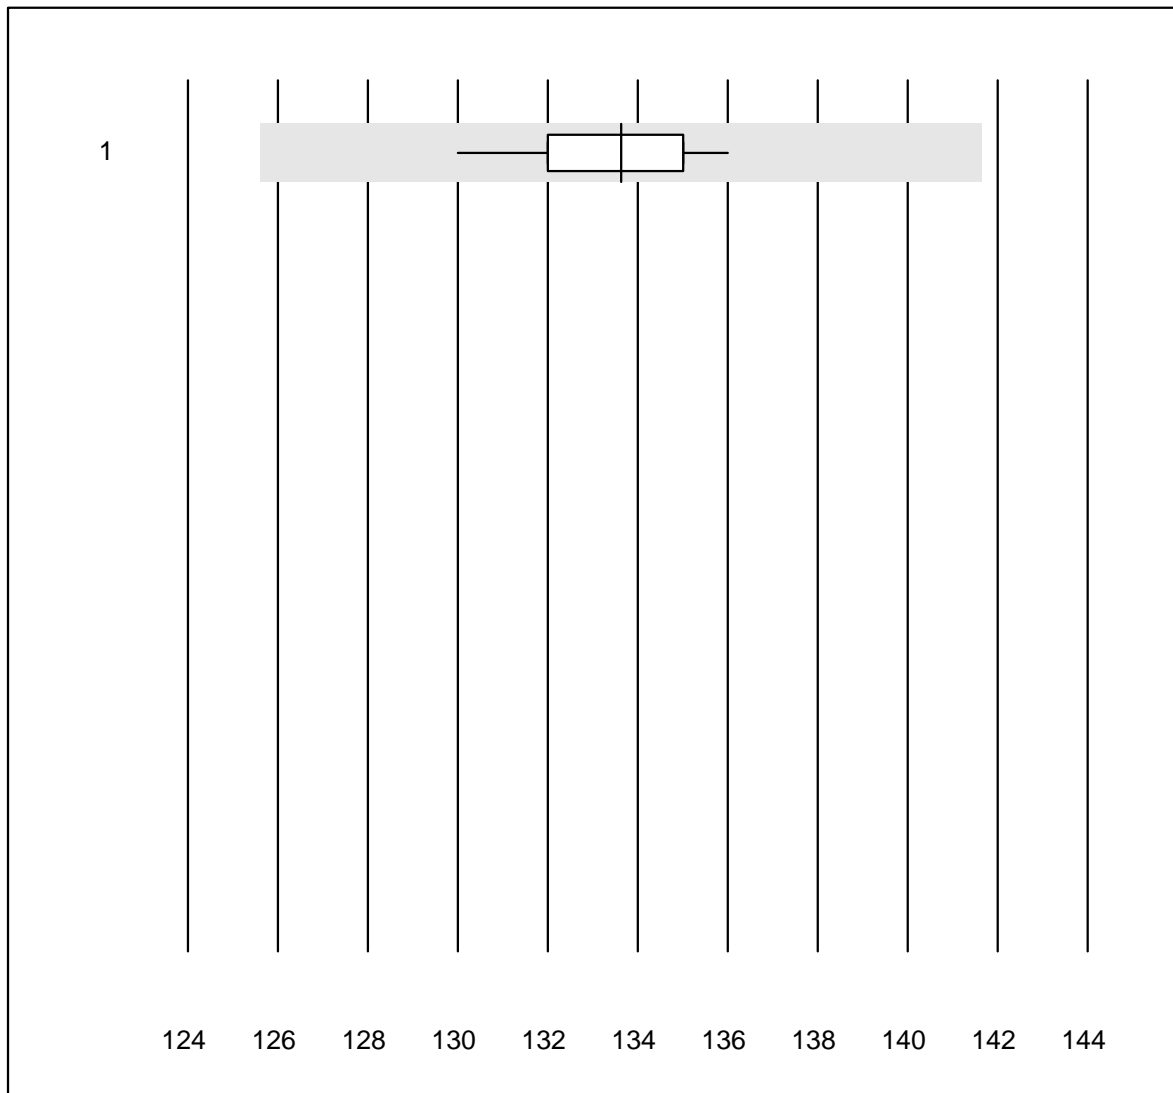


QUALAB Toleranz : 6 %

Natrium-K22 (mmol/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 ISE	11	100.0	0.0	0.0	134	1.3	e

Glukose-K22

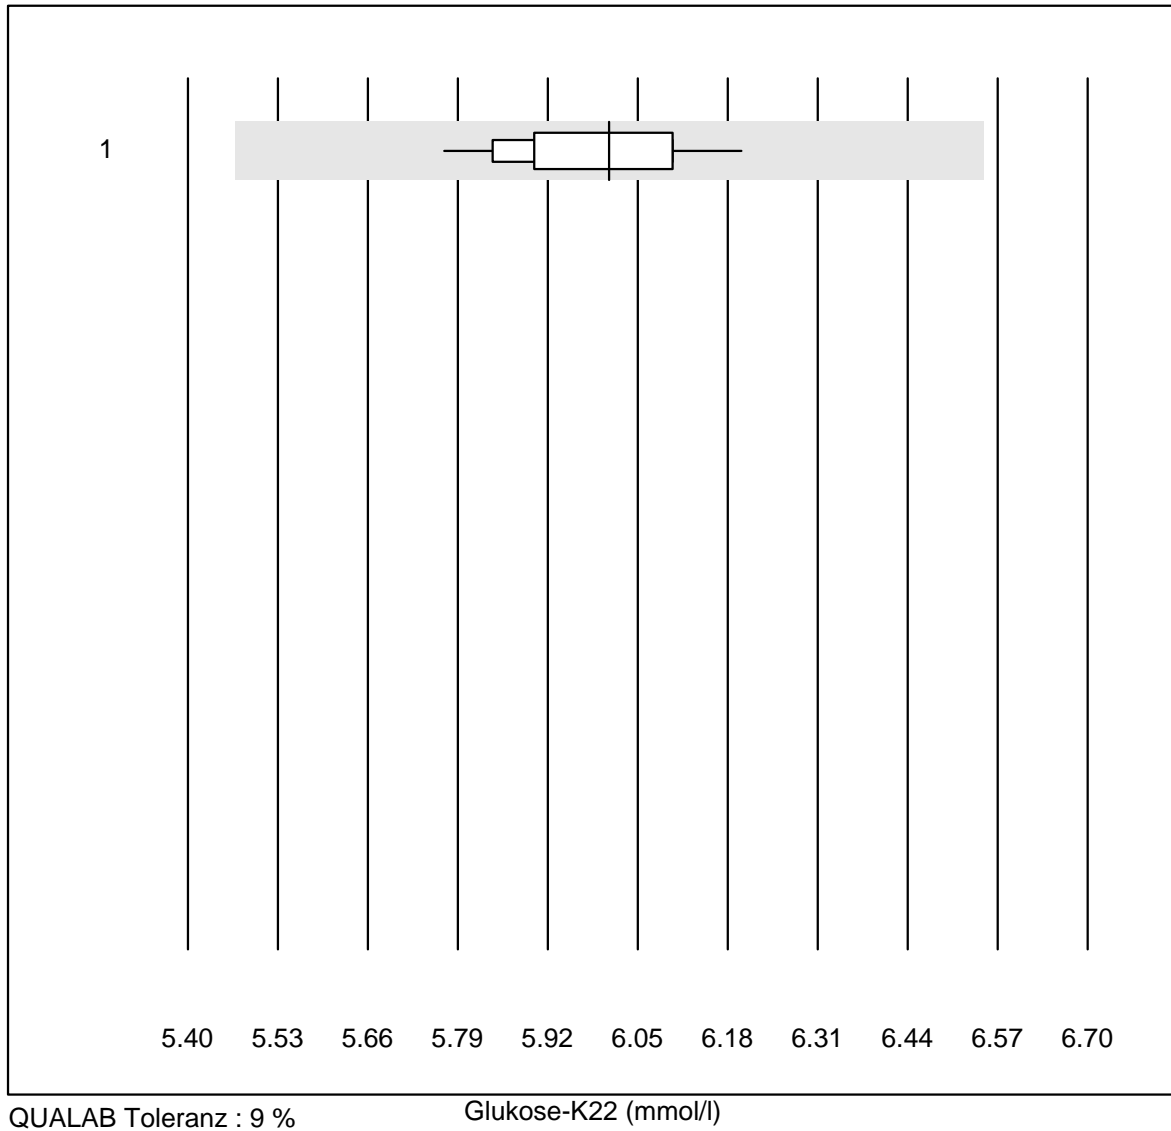


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Chimie humide	11	100.0	0.0	0.0	6.0	2.1	e

Harnstoff-K22

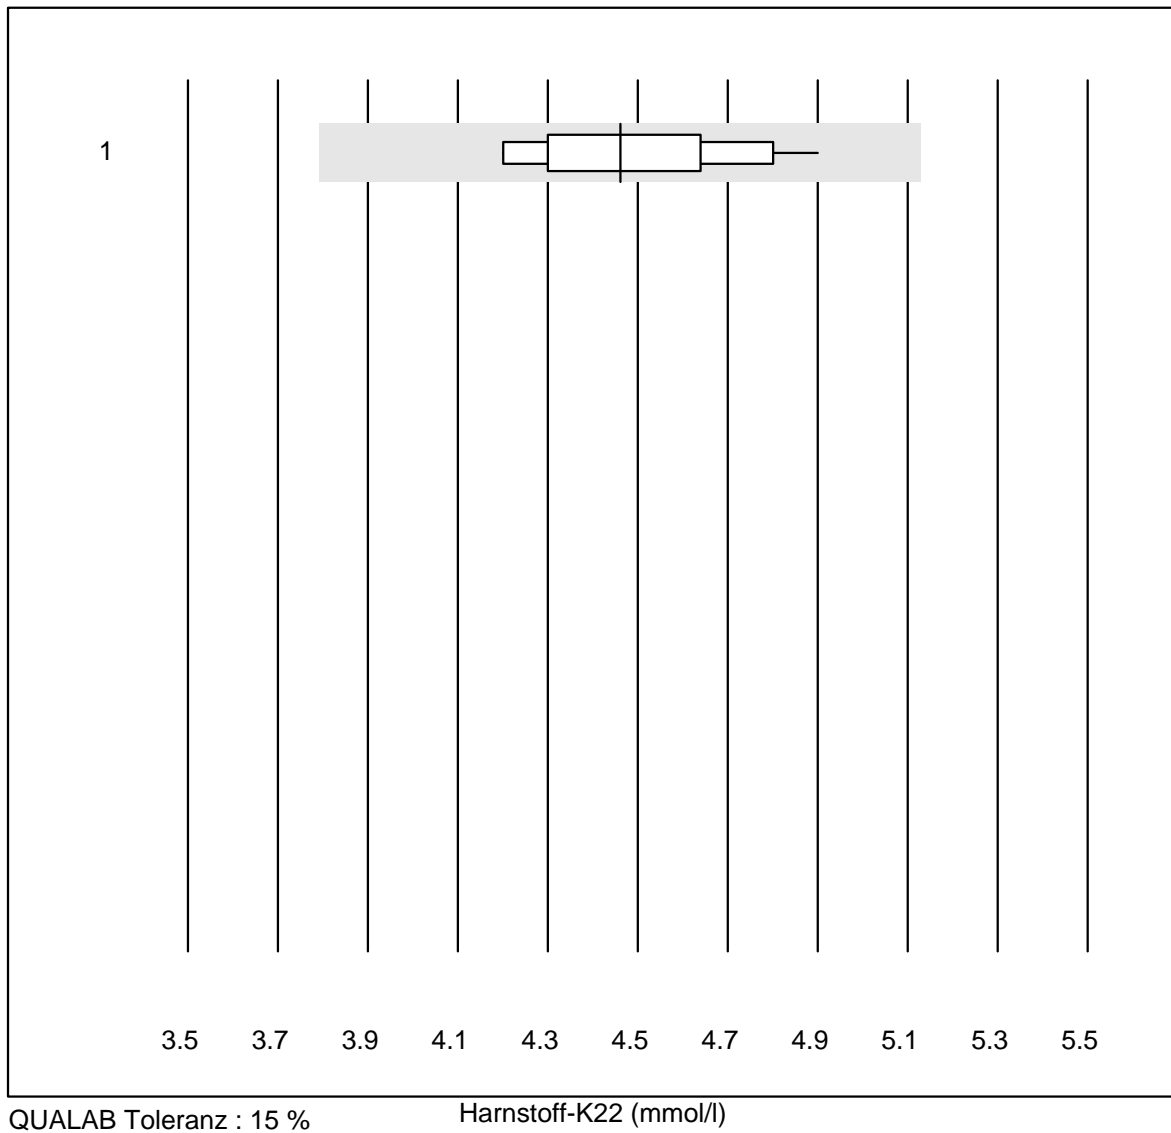


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Chimie humide	11	100.0	0.0	0.0	4.5	5.4	e

Osmotische Lücke

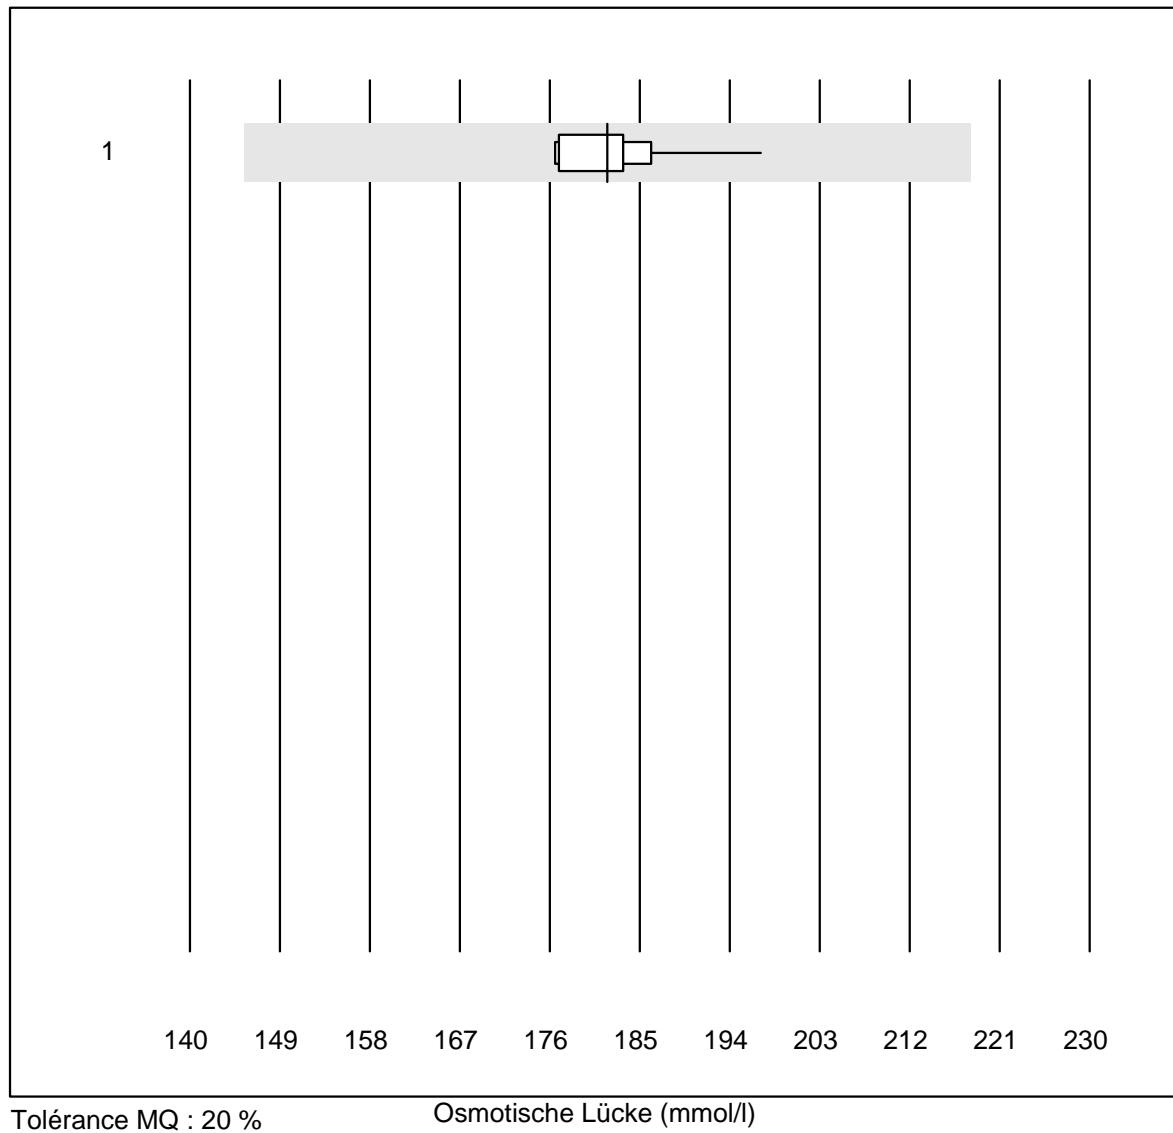

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Formel 1 (2Na+K+Glu+	11	100.0	0.0	0.0	181.8	3.3	e

Digoxin

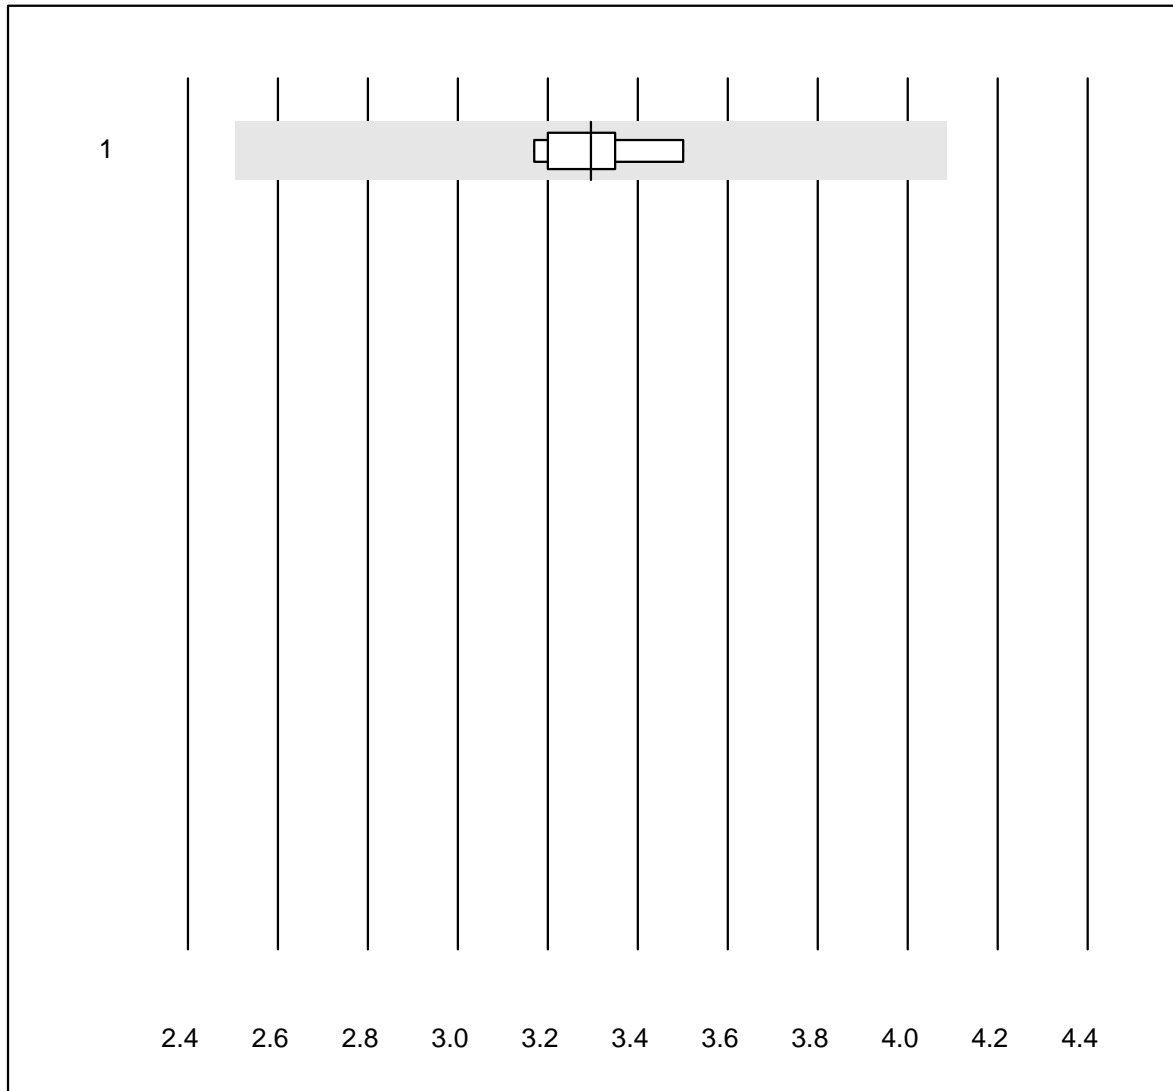


QUALAB Toleranz : 24 %

Digoxin (nmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Autres méthodes	6	100.0	0.0	0.0	3.30	3.6	e

Paracetamol

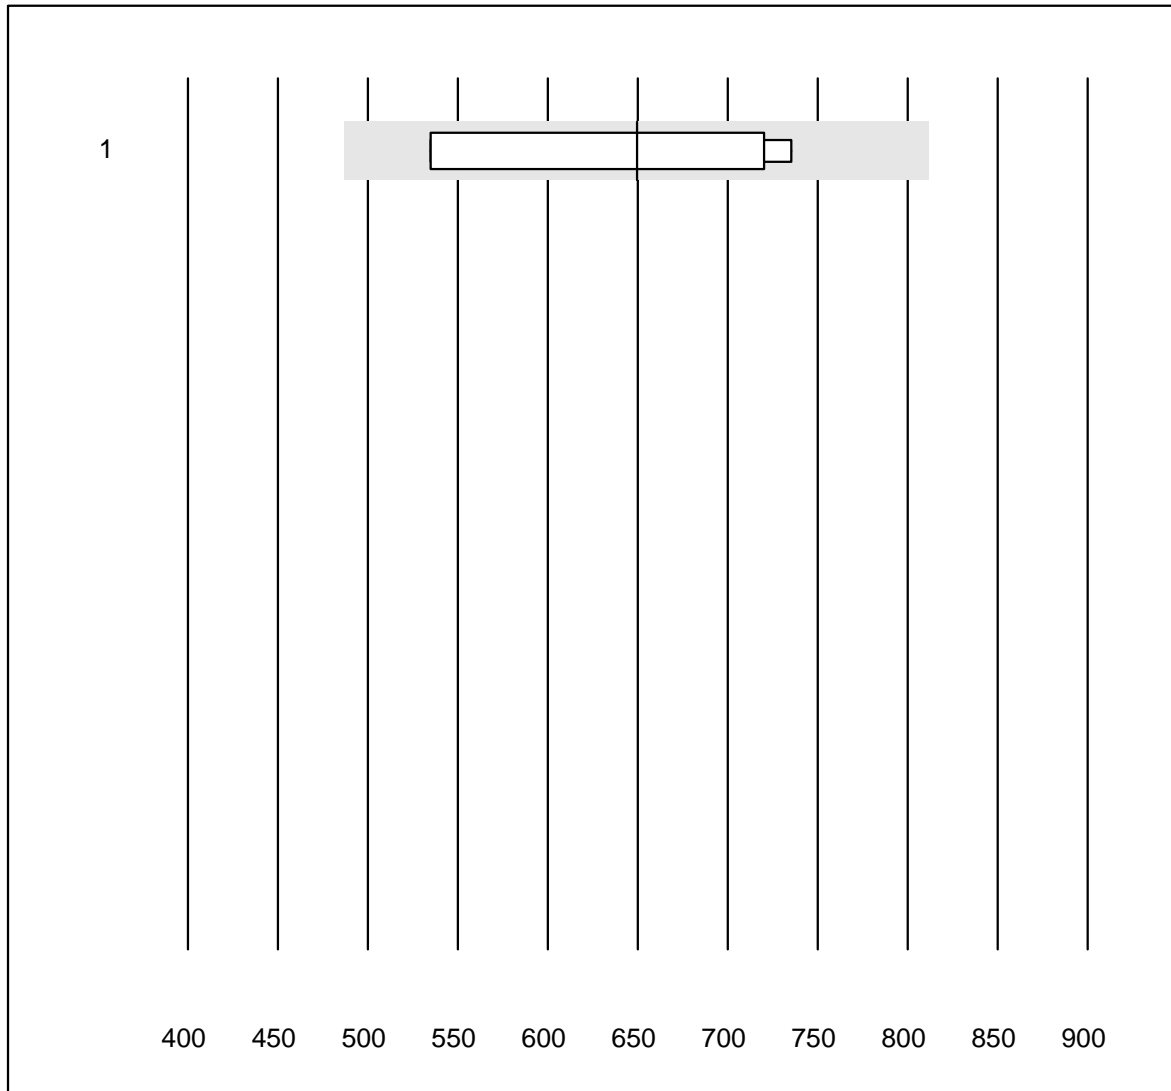


Tolérance MQ : 25 %

Paracetamol (µmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	649.5	15.6	e*

Valproat

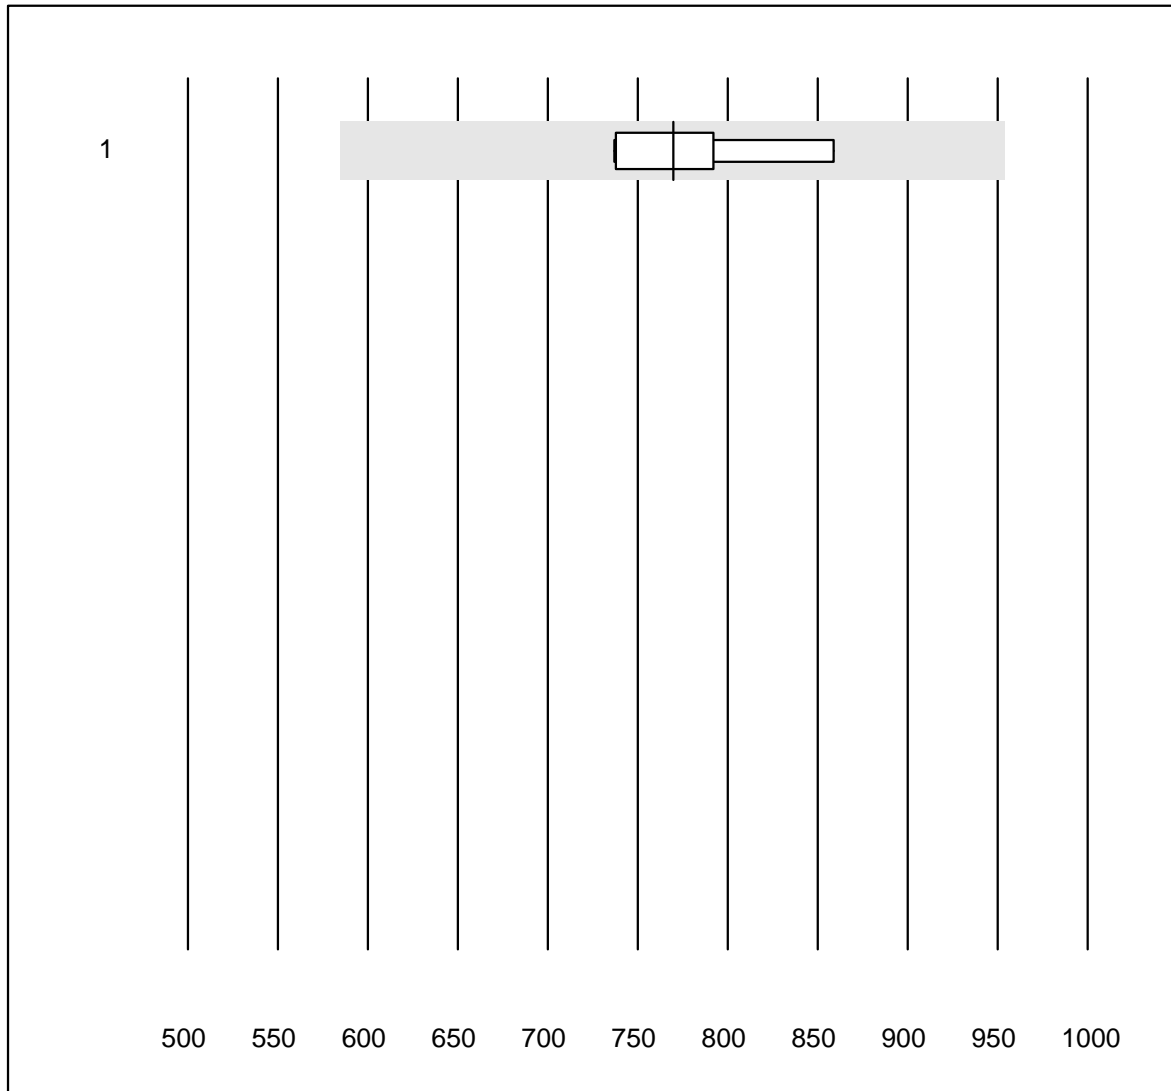


Tolérance MQ : 24 %

Valproat (µmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	769.6	5.9	e

Cystatin C

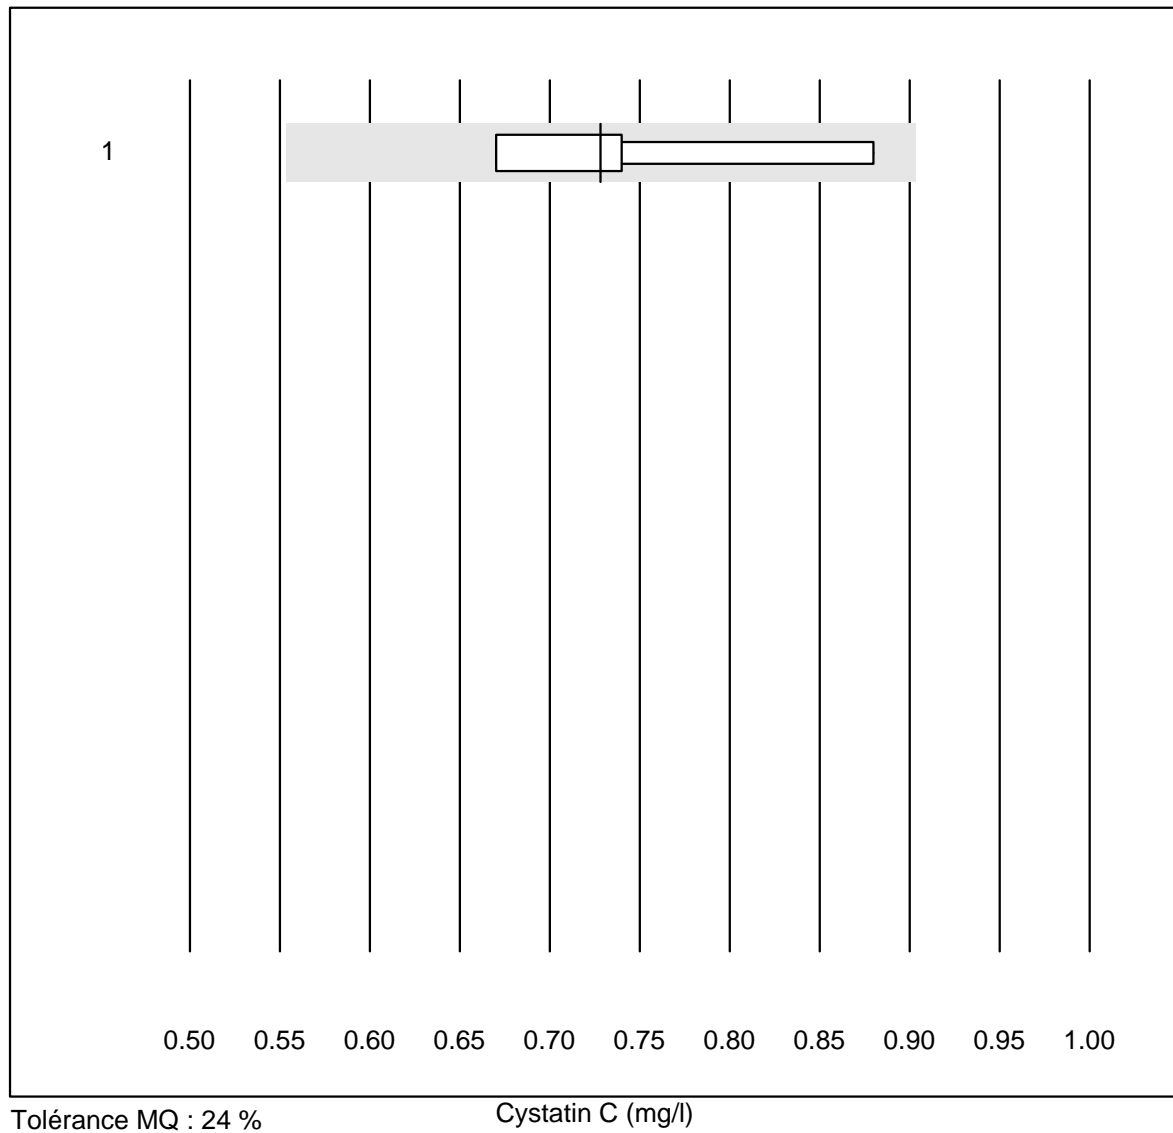


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	8	100.0	0.0	0.0	0.73	9.7	a

Éthanol

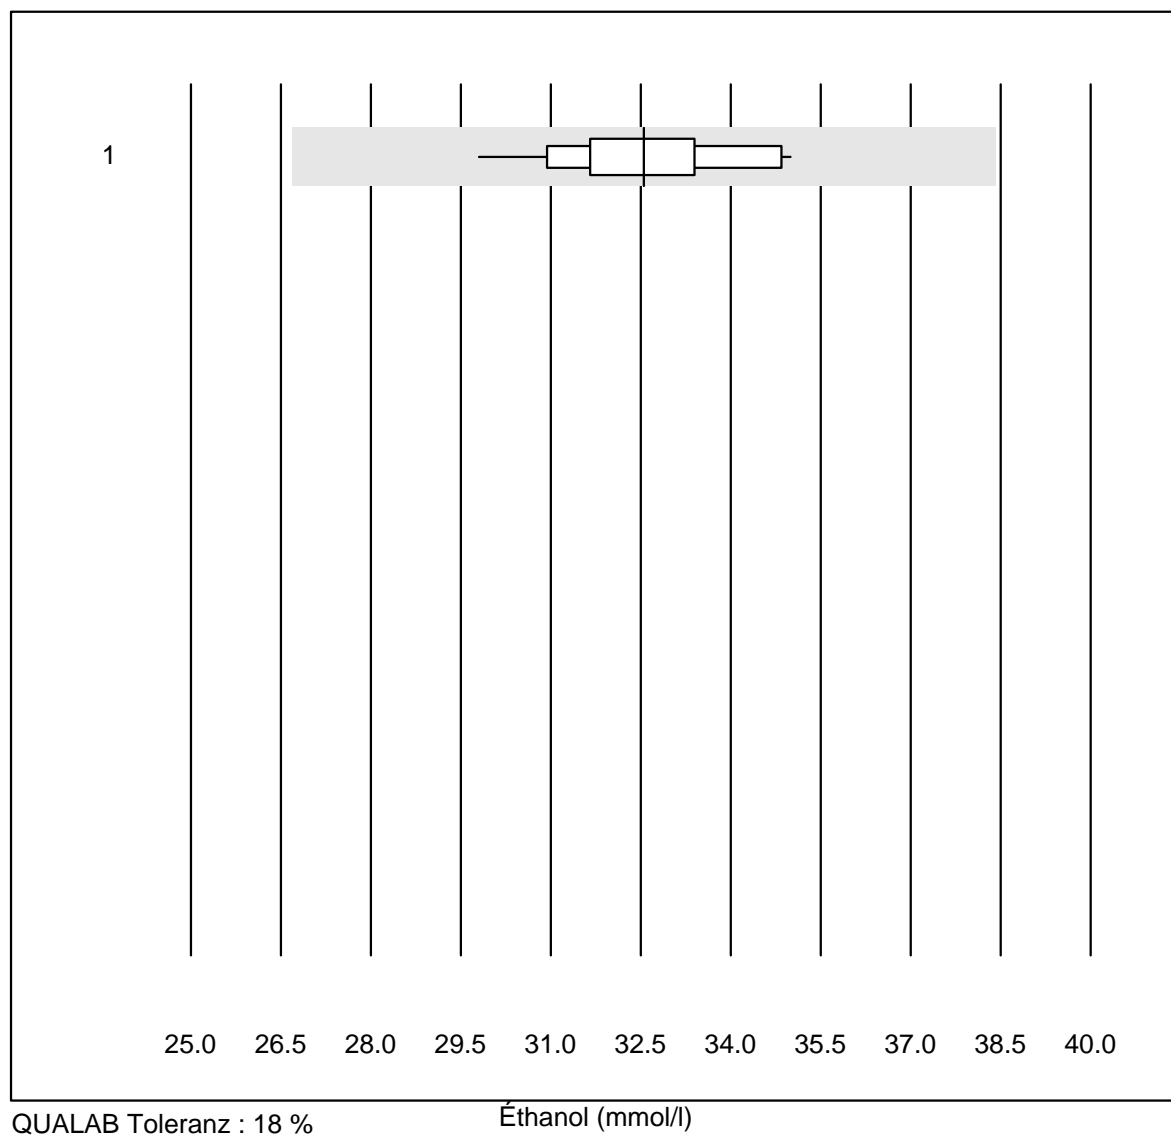


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	27	100.0	0.0	0.0	32.5	4.1	e

Ammoniac

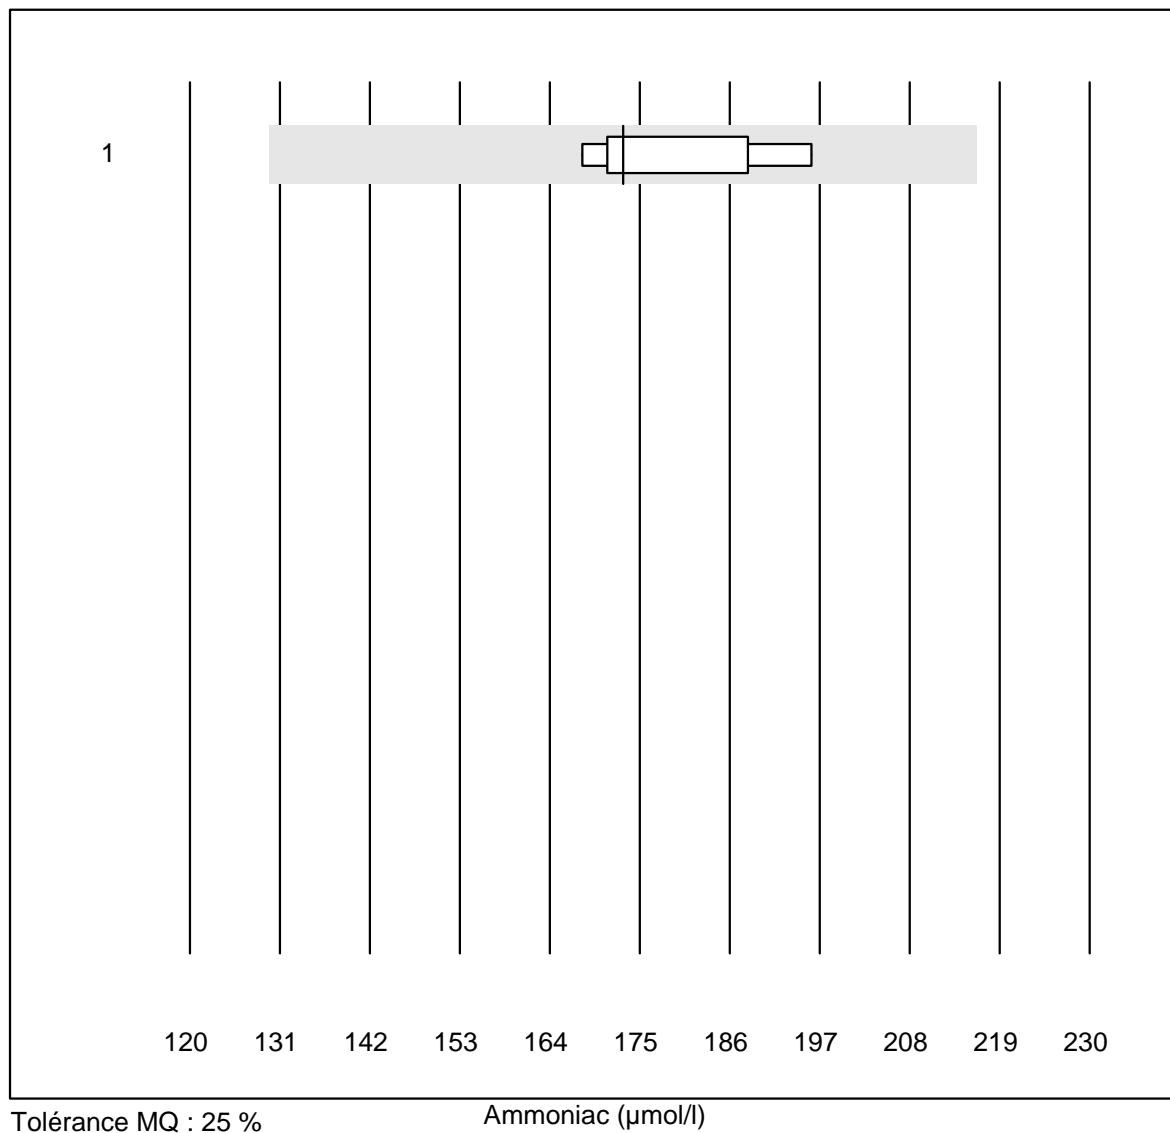


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	173.0	5.9	e

Calprotectine

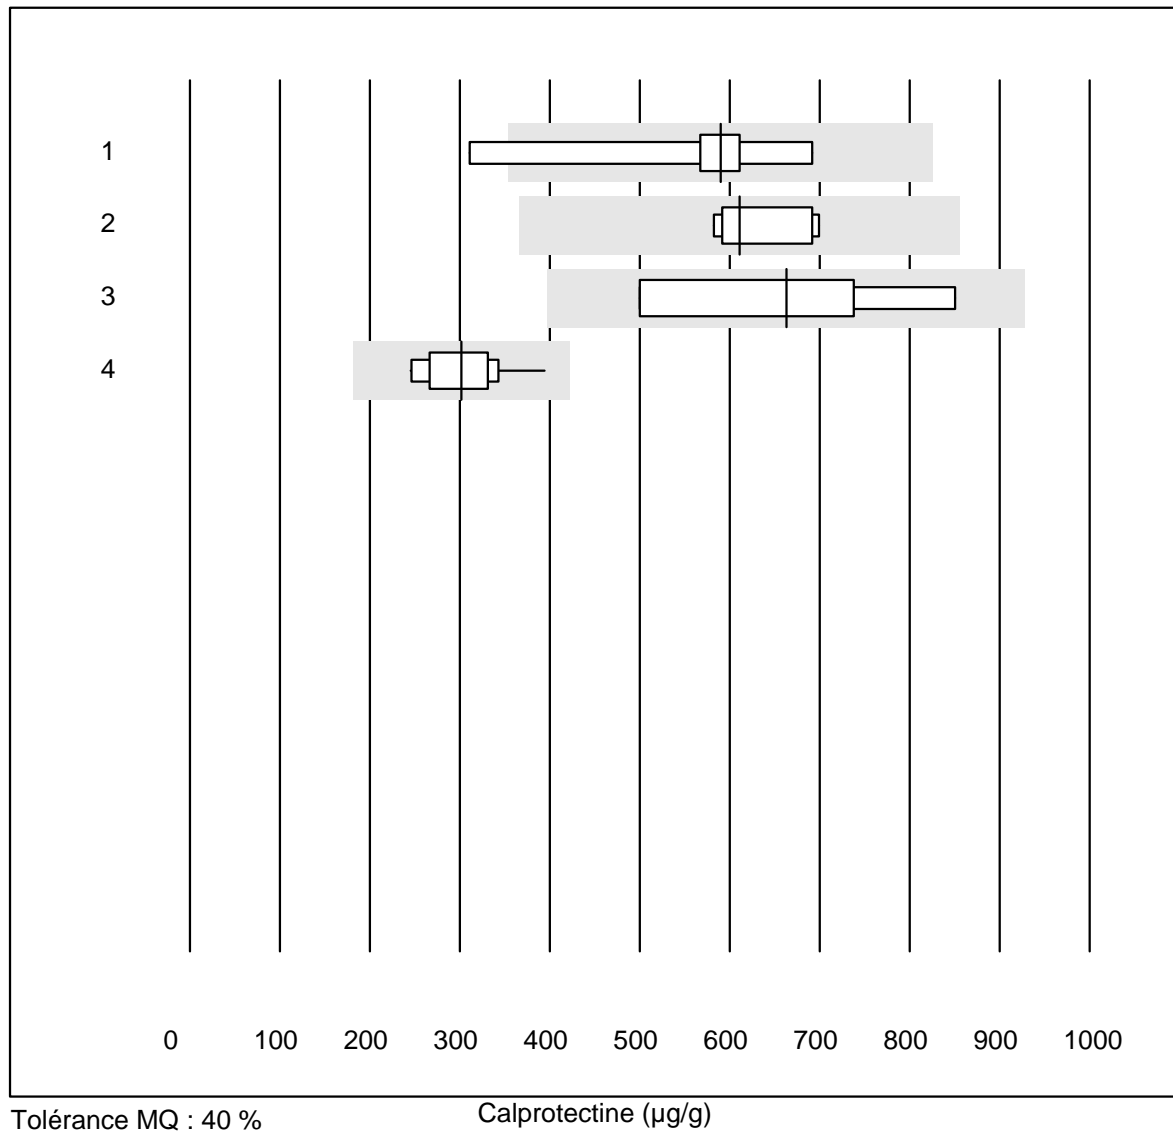

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Bühlmann ELISA	5	80.0	20.0	0.0	590	26.0	a
2	Bühlmann fCALturbo	9	100.0	0.0	0.0	611	7.8	e
3	Bühlmann Quantum Blu	4	100.0	0.0	0.0	663	23.3	e*
4	Liaison	21	95.2	0.0	4.8	302	13.4	e

Cholestérol Af/b101

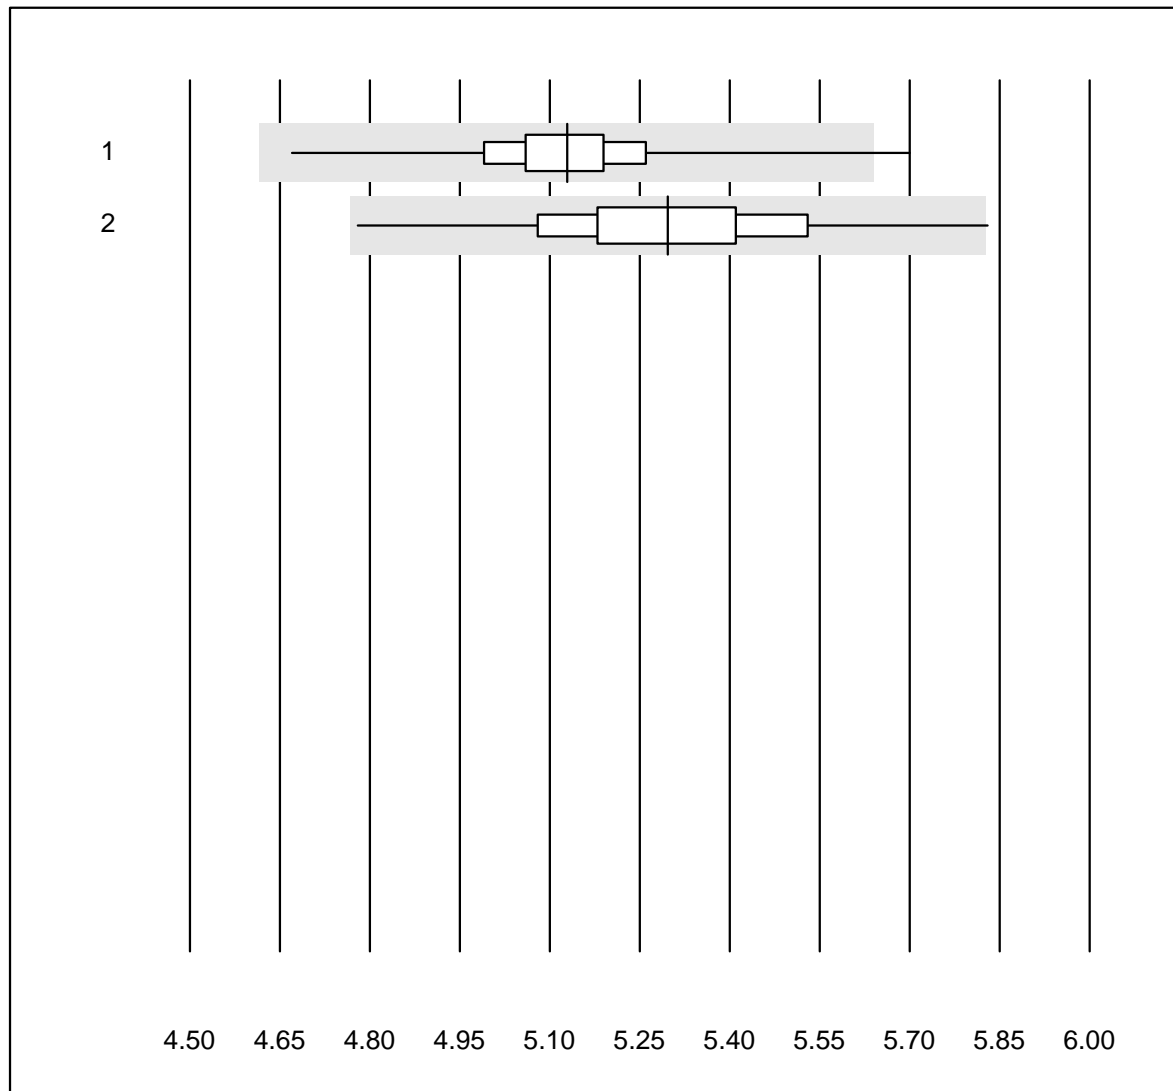


QUALAB Toleranz : 10 %

Cholestérol Af/b101 (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas b101	191	99.5	0.5	0.0	5.13	2.3	e
2 Afinion	451	99.1	0.2	0.7	5.30	3.4	e

Cholestérol HDL Af/b101

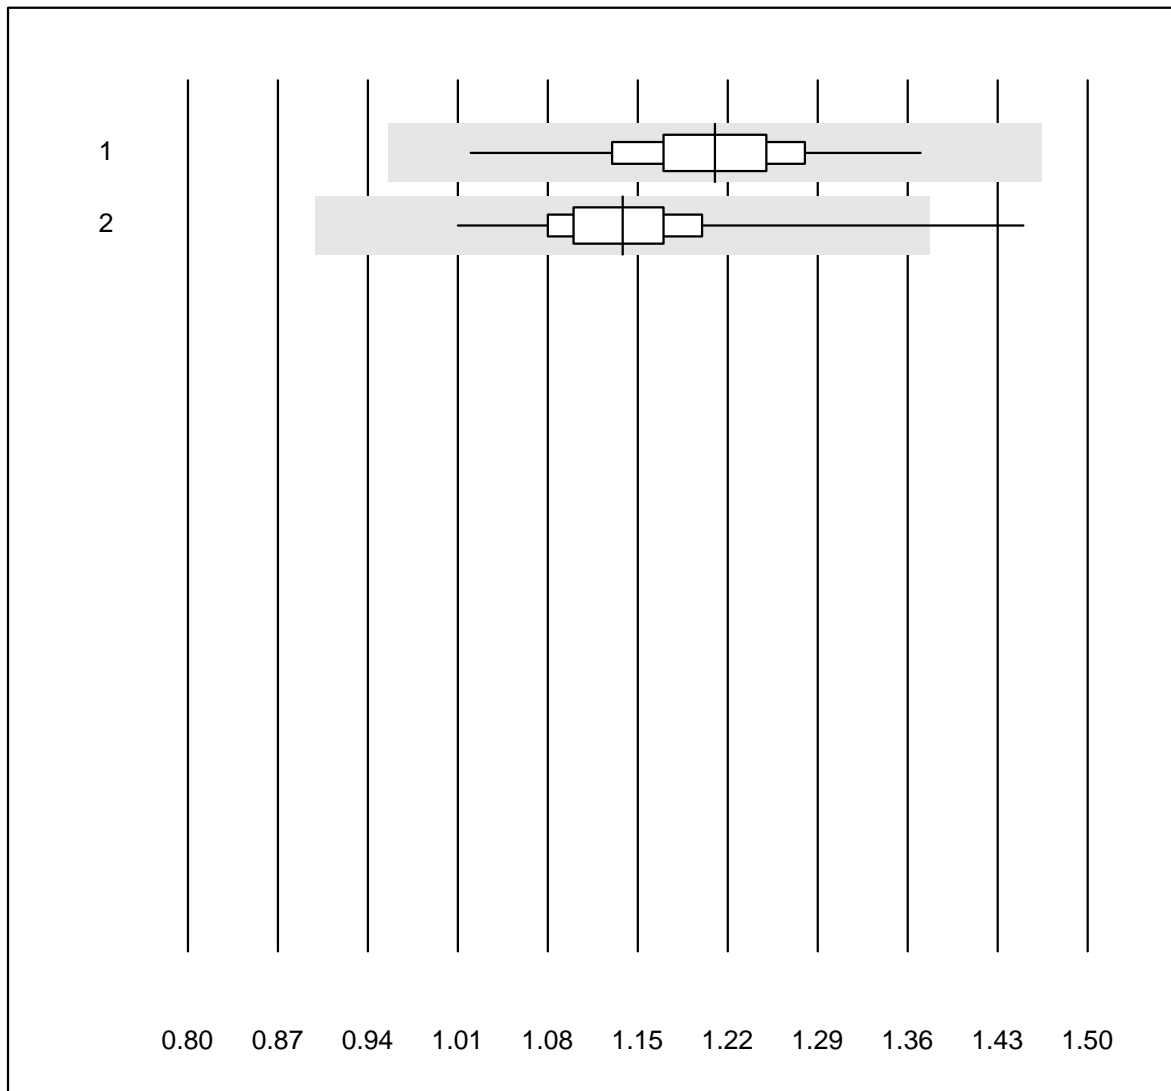


QUALAB Toleranz : 21 %

Cholestérol HDL Af/b101 (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cobas b101	189	93.1	0.0	6.9	1.21	4.9	e
2	Afinion	446	91.8	0.4	7.8	1.14	4.7	e

Triglycerides Af/b101

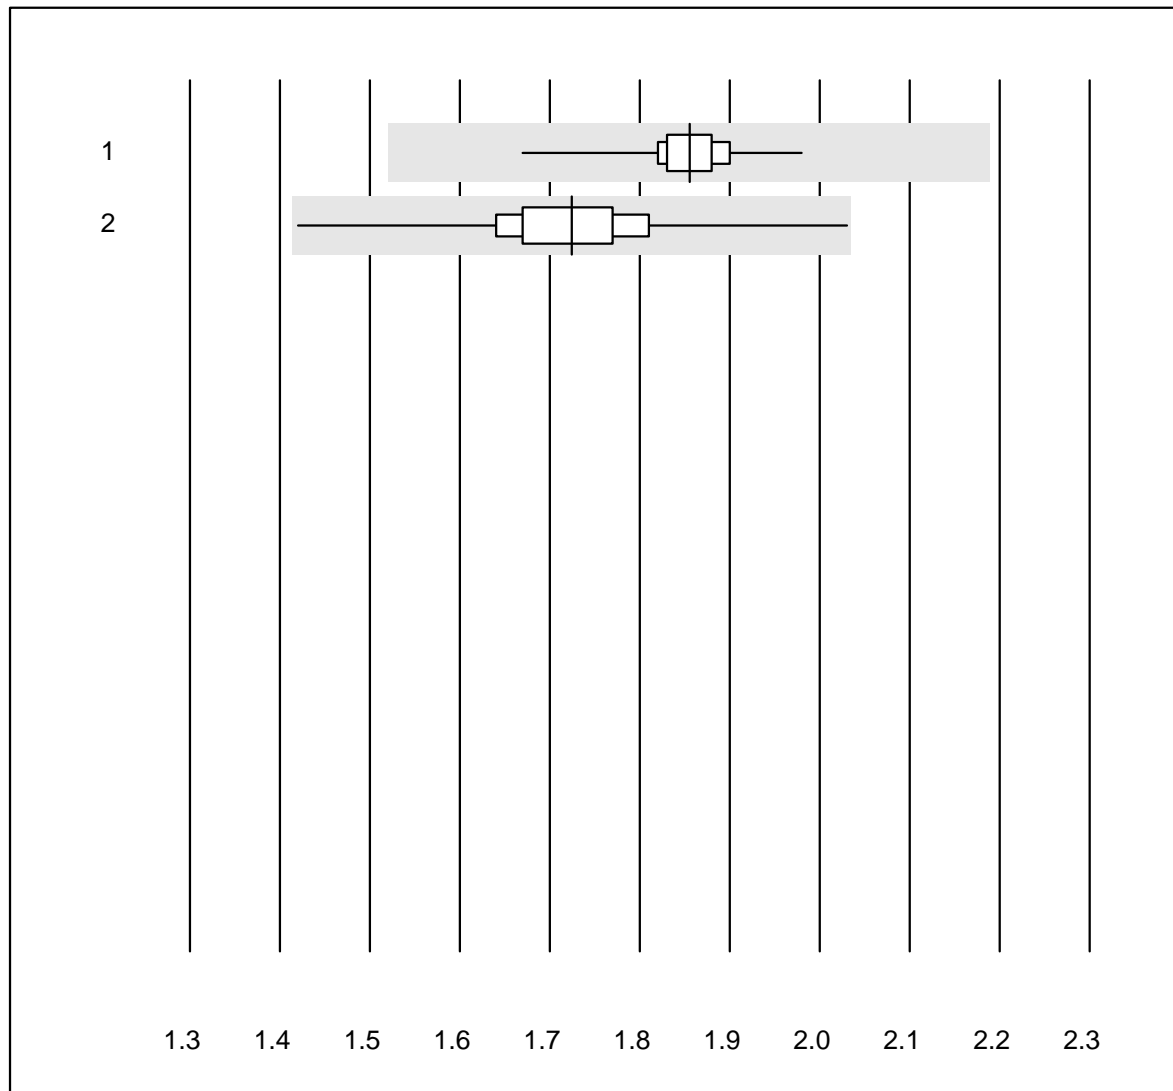


QUALAB Toleranz : 18 %

Triglycerides Af/b101 (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas b101	190	98.4	0.0	1.6	1.86	2.1	e
2 Afinion	451	99.3	0.0	0.7	1.72	4.2	e

Troponine I S

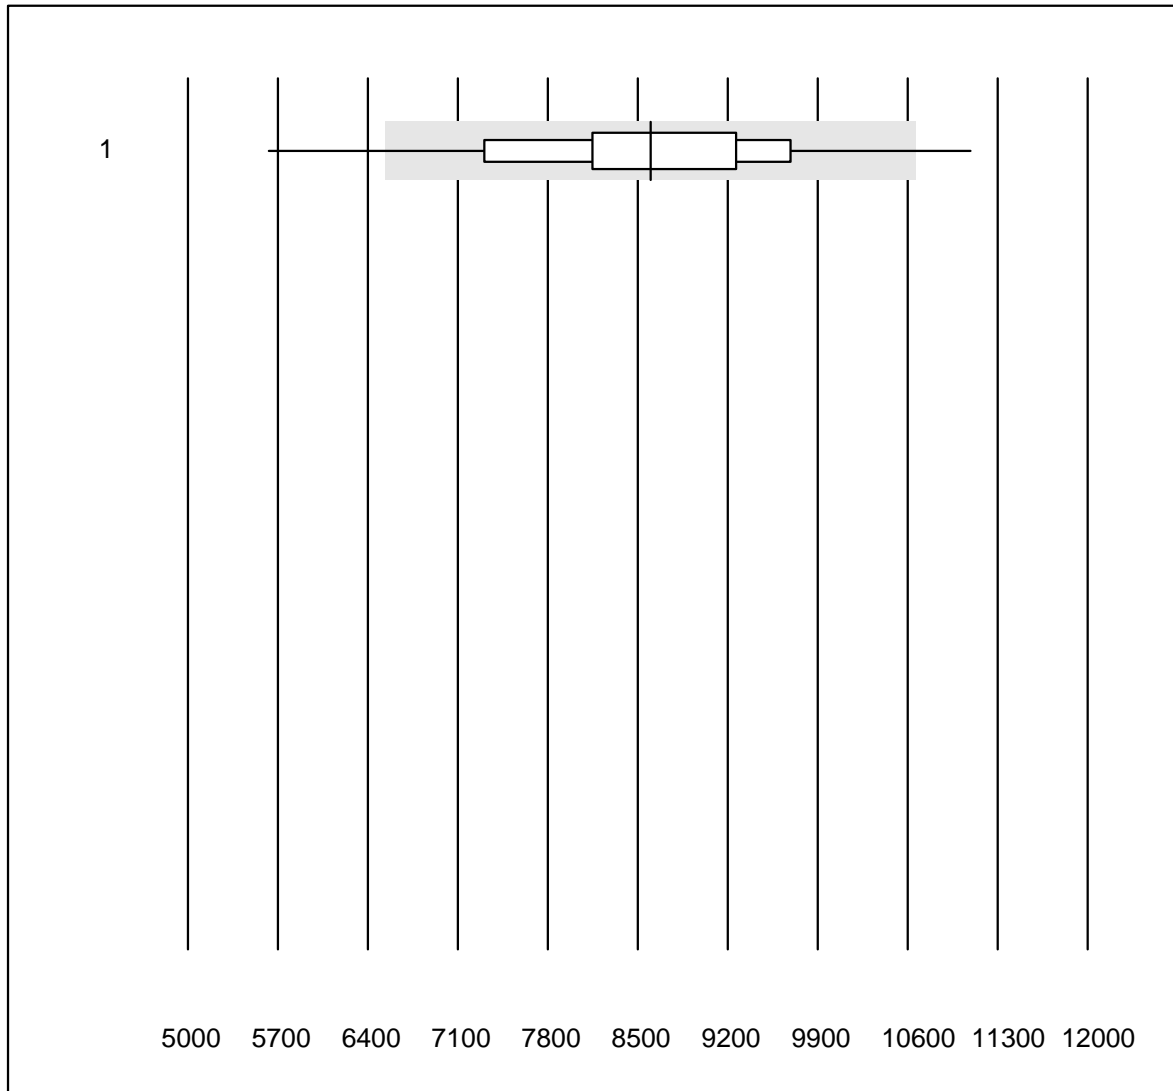


QUALAB Toleranz : 24 %

Troponine I S (ng/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 AFIAS	160	84.4	7.5	8.1	8602.23	11.4	e

D-Dimères qn S

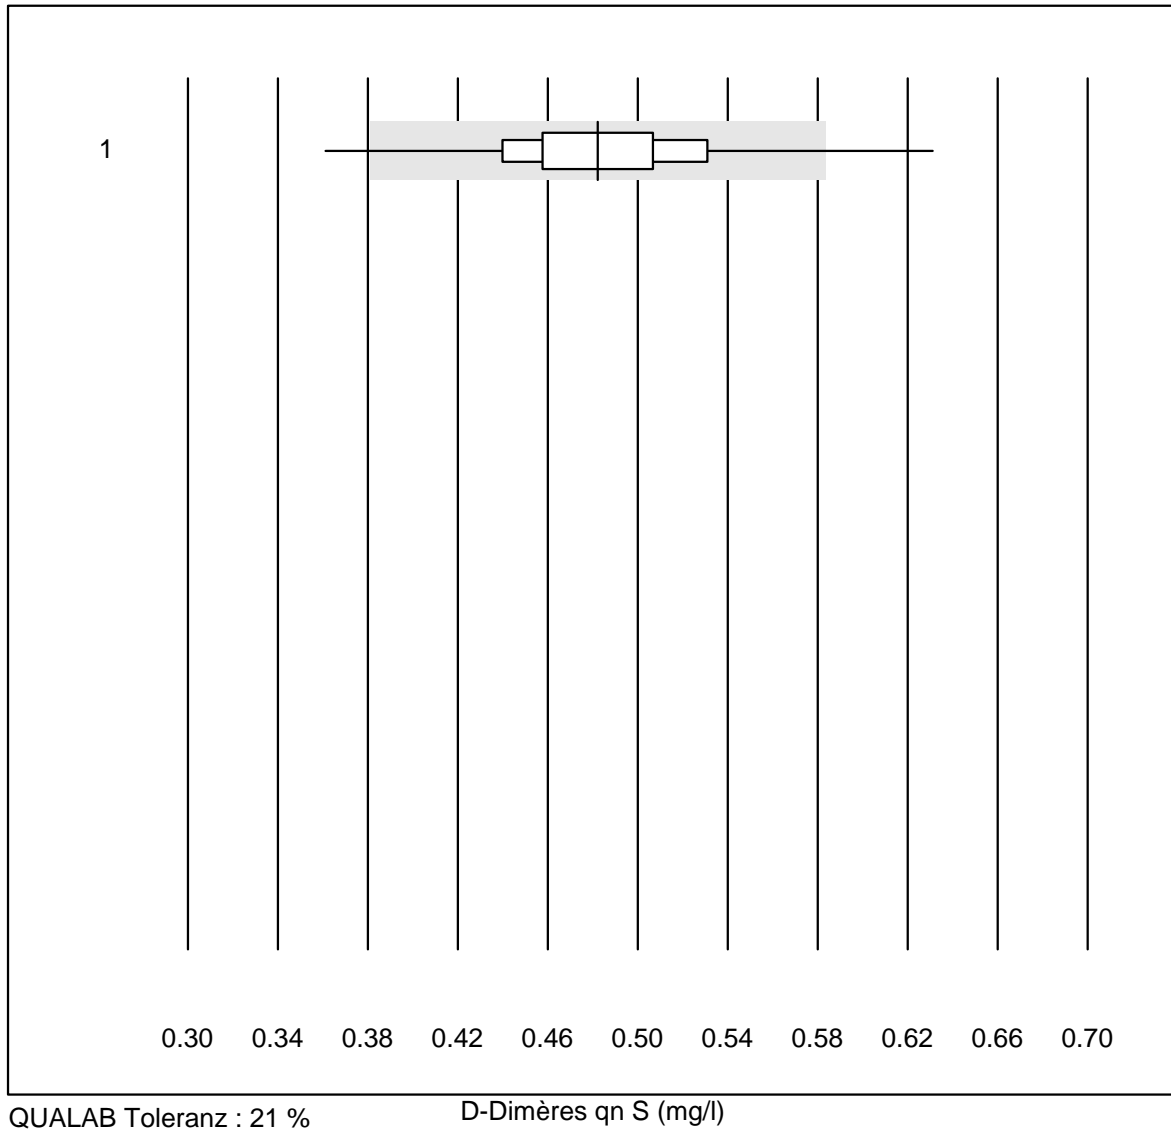

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 AFIAS	167	90.4	2.4	7.2	0.48	8.2	e

NT-proBNP S

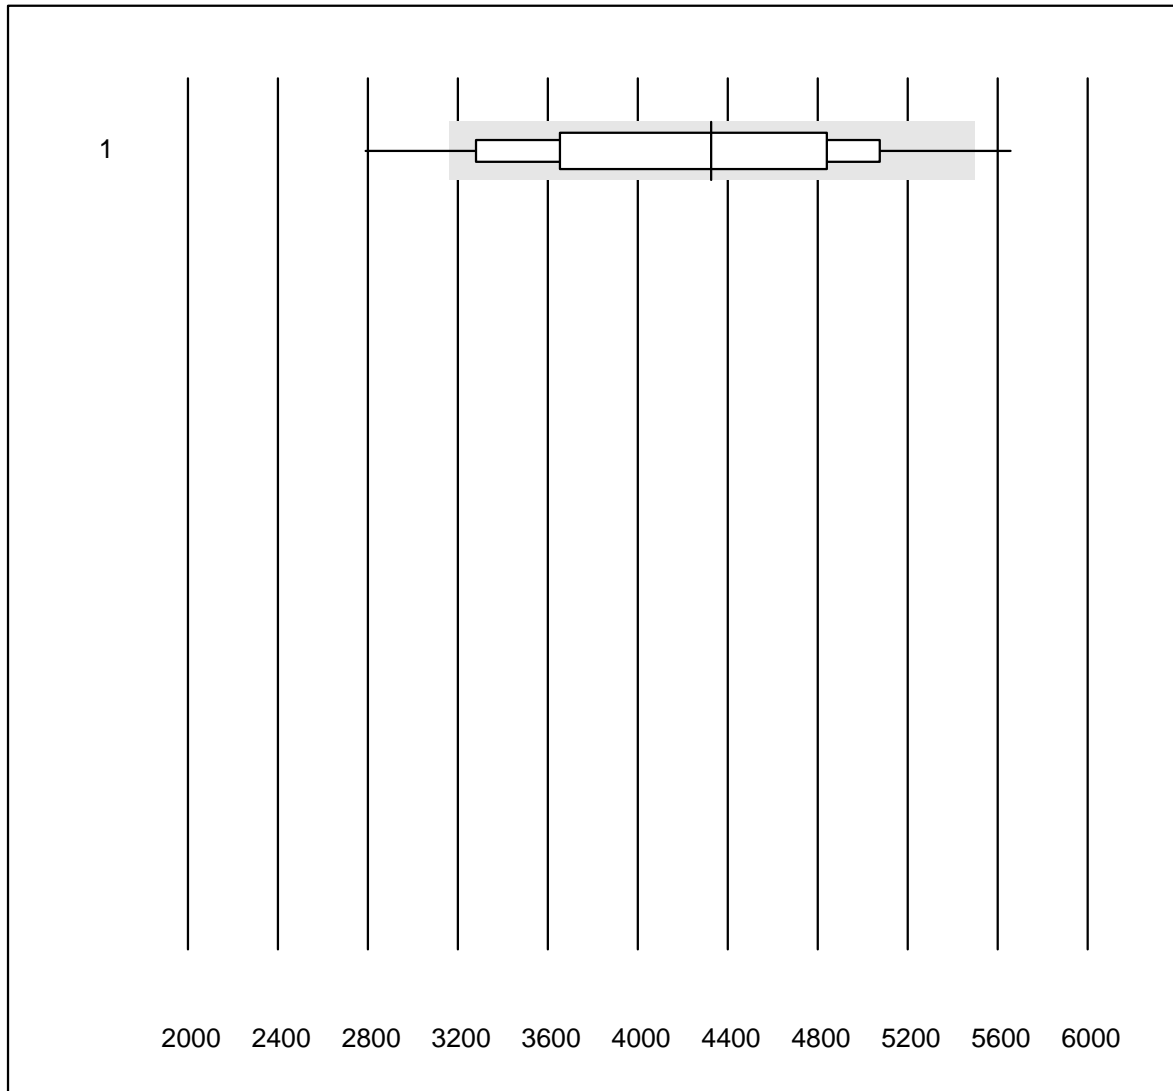


QUALAB Toleranz : 27 %

NT-proBNP S (ng/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 AFIAS	123	91.1	8.1	0.8	4327.6	16.3	e

Lipase

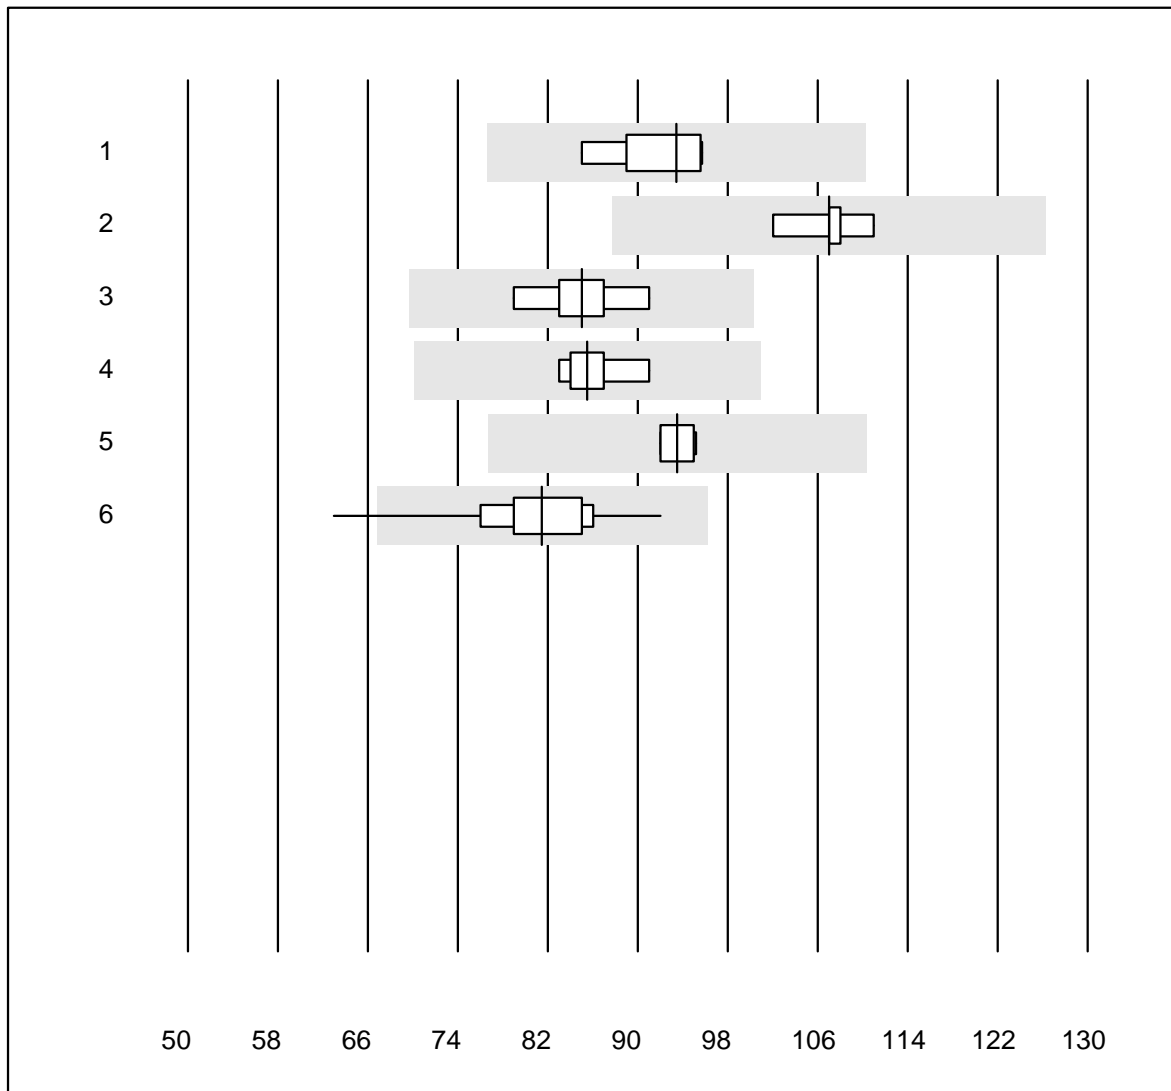


QUALAB Toleranz : 18 %

Lipase (U/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Roche	7	100.0	0.0	0.0	93.4	4.4	e
2	Siemens Advia	5	100.0	0.0	0.0	107.0	3.0	e
3	Architect	5	100.0	0.0	0.0	85.0	5.3	e*
4	Beckman	8	87.5	0.0	12.5	85.5	3.0	e
5	Cobas	4	100.0	0.0	0.0	93.5	1.9	e
6	Fuji Dri-Chem	148	97.9	0.7	1.4	81.5	5.5	e

Bicarbonat

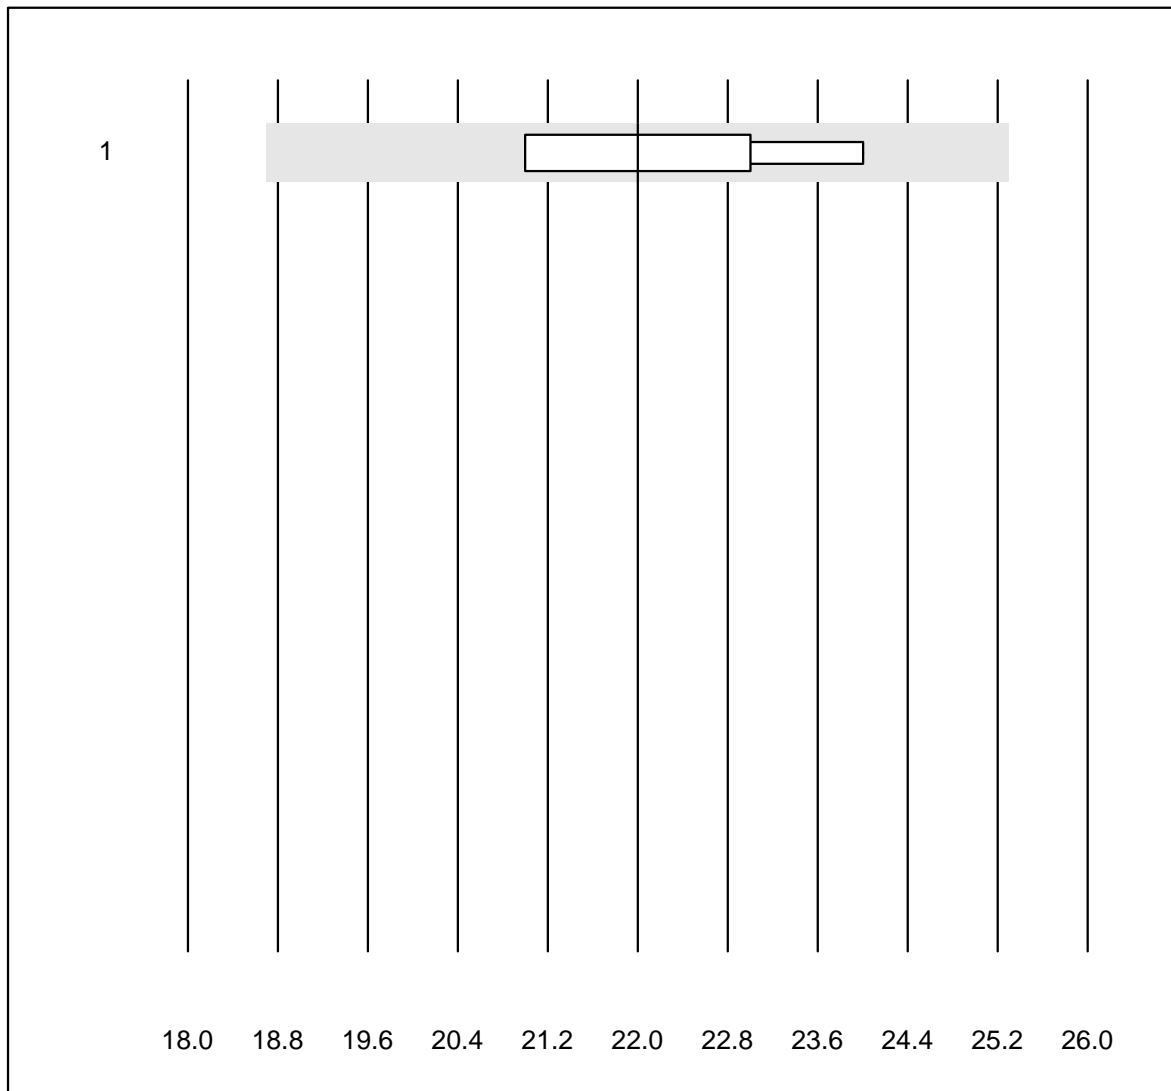


Tolérance MQ : 15 %

Bicarbonat (mmol/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Piccolo	4	100.0	0.0	0.0	22.0	6.7	e*

Cholinestérase

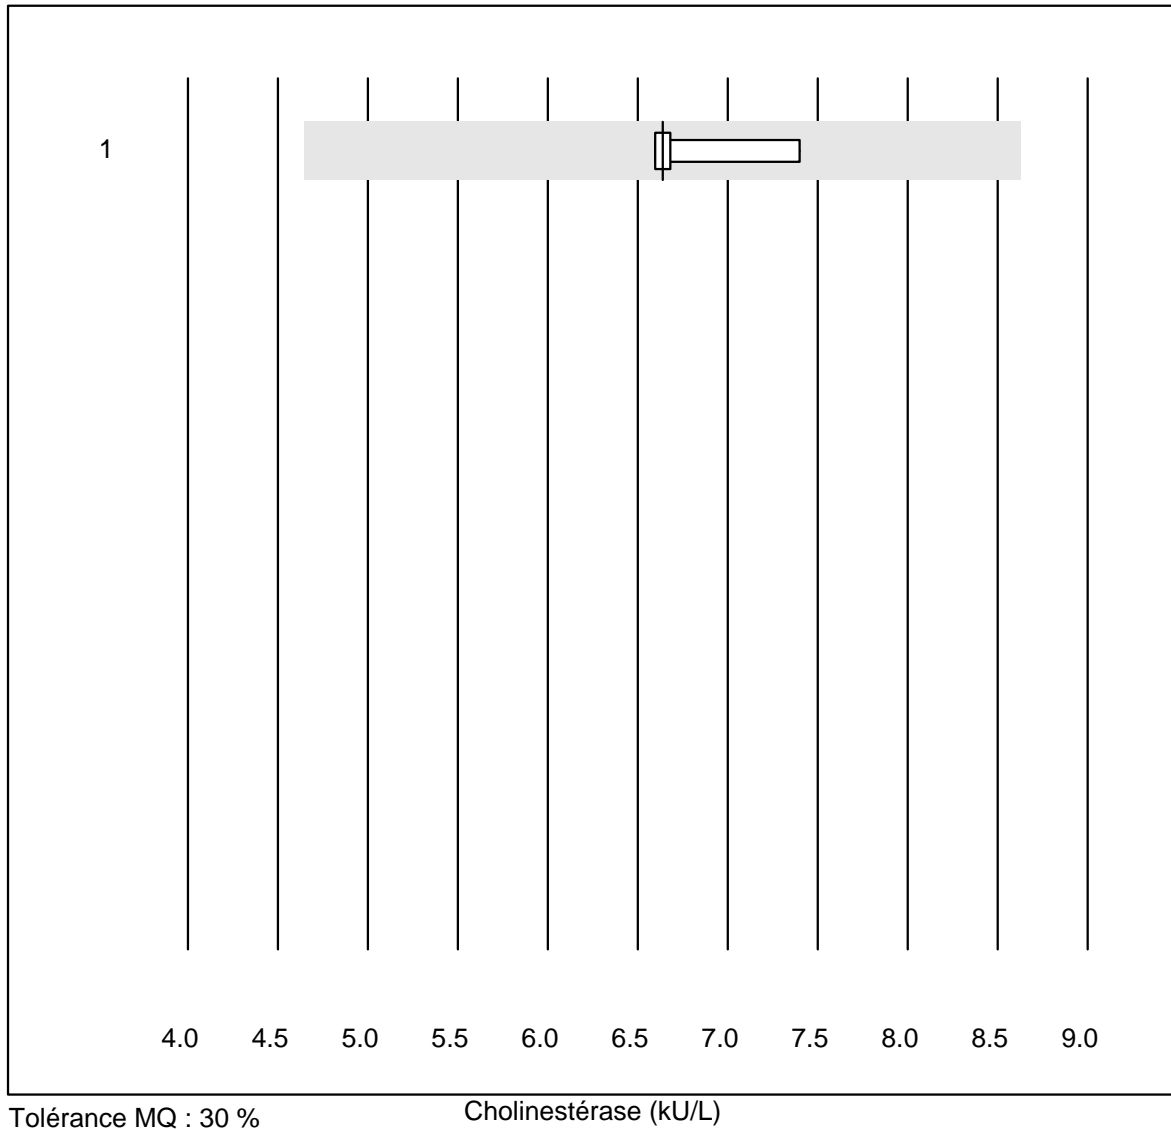

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	6.6	5.7	e

Glucose CSF

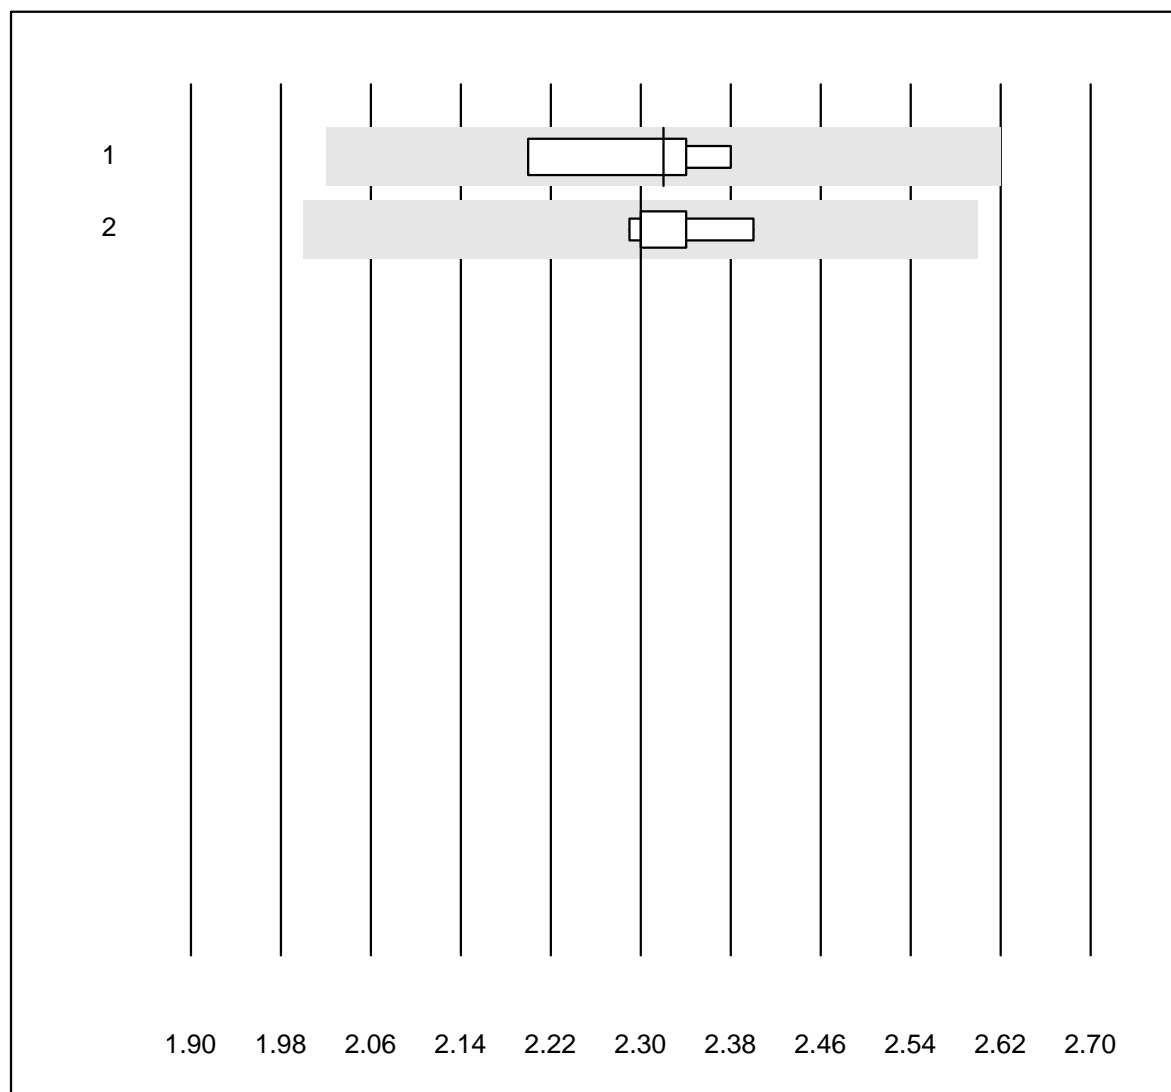


QUALAB Toleranz : 9 %
(< 3.30: +/- 0.30 mmol/l)

Glucose CSF (mmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	2.32	3.4	e*
2 Autres méthodes	9	100.0	0.0	0.0	2.30	1.6	e

Lactate CSF

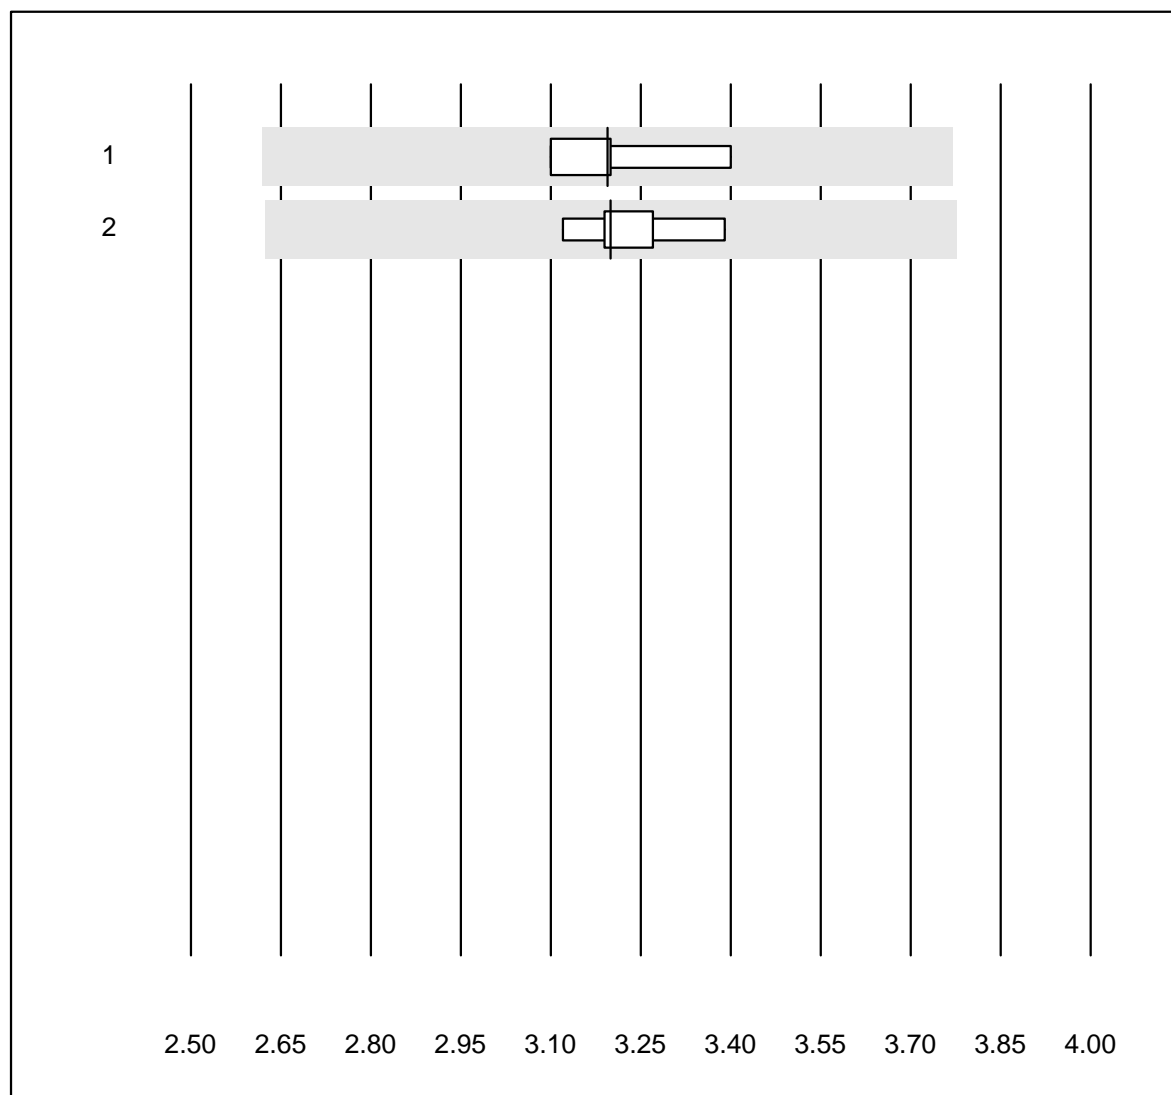


QUALAB Toleranz : 18 %

Lactate CSF (mmol/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	3.20	3.9	e
2 Autres méthodes	7	100.0	0.0	0.0	3.20	2.6	e

Protéine CSF

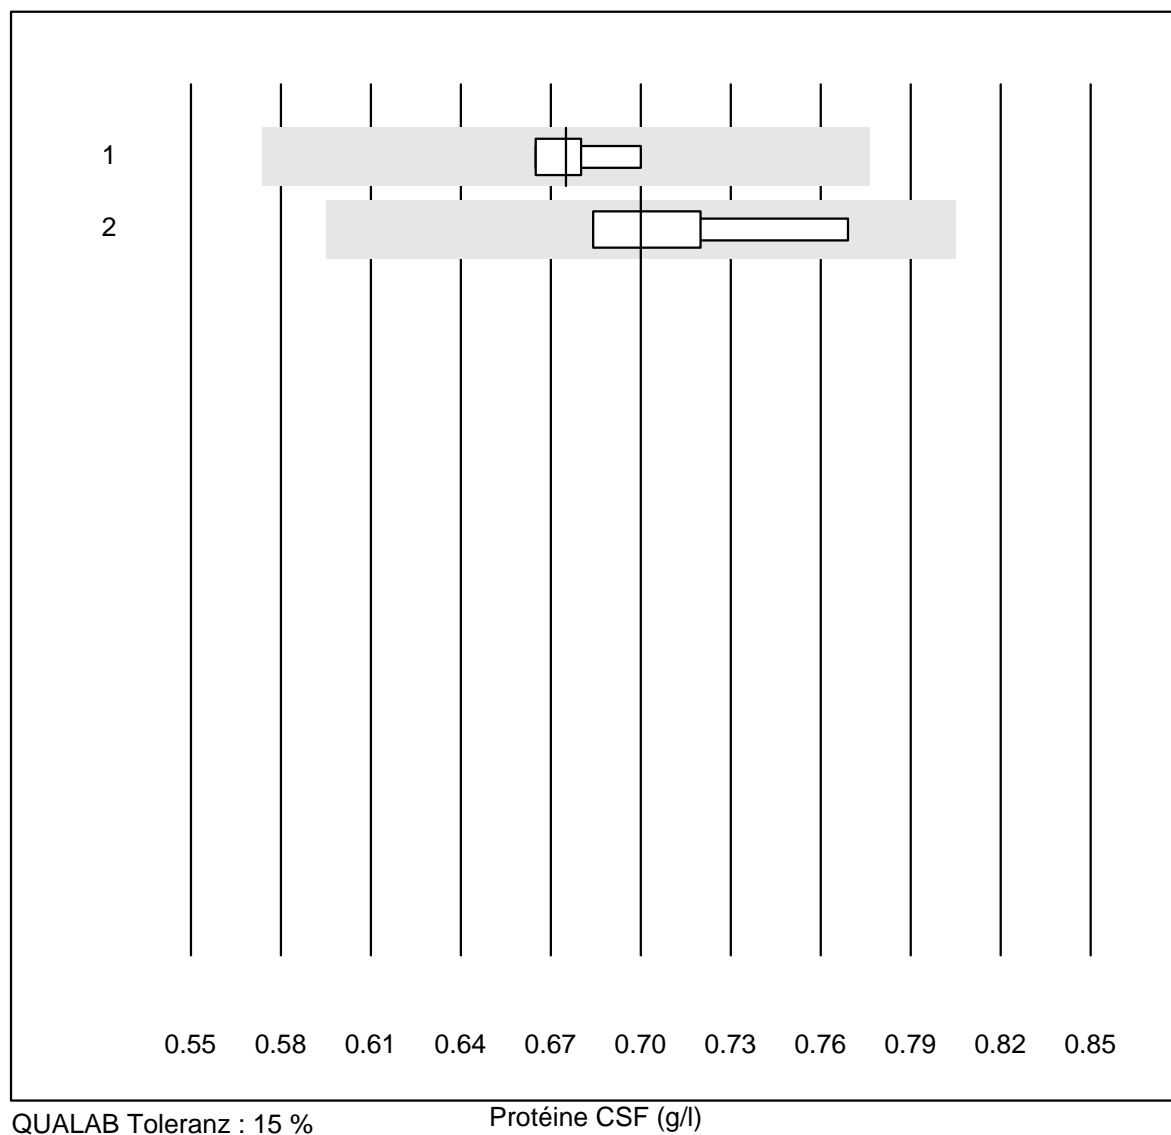


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	0.68	2.3	e
2 Autres méthodes	7	100.0	0.0	0.0	0.70	4.3	e

CDT

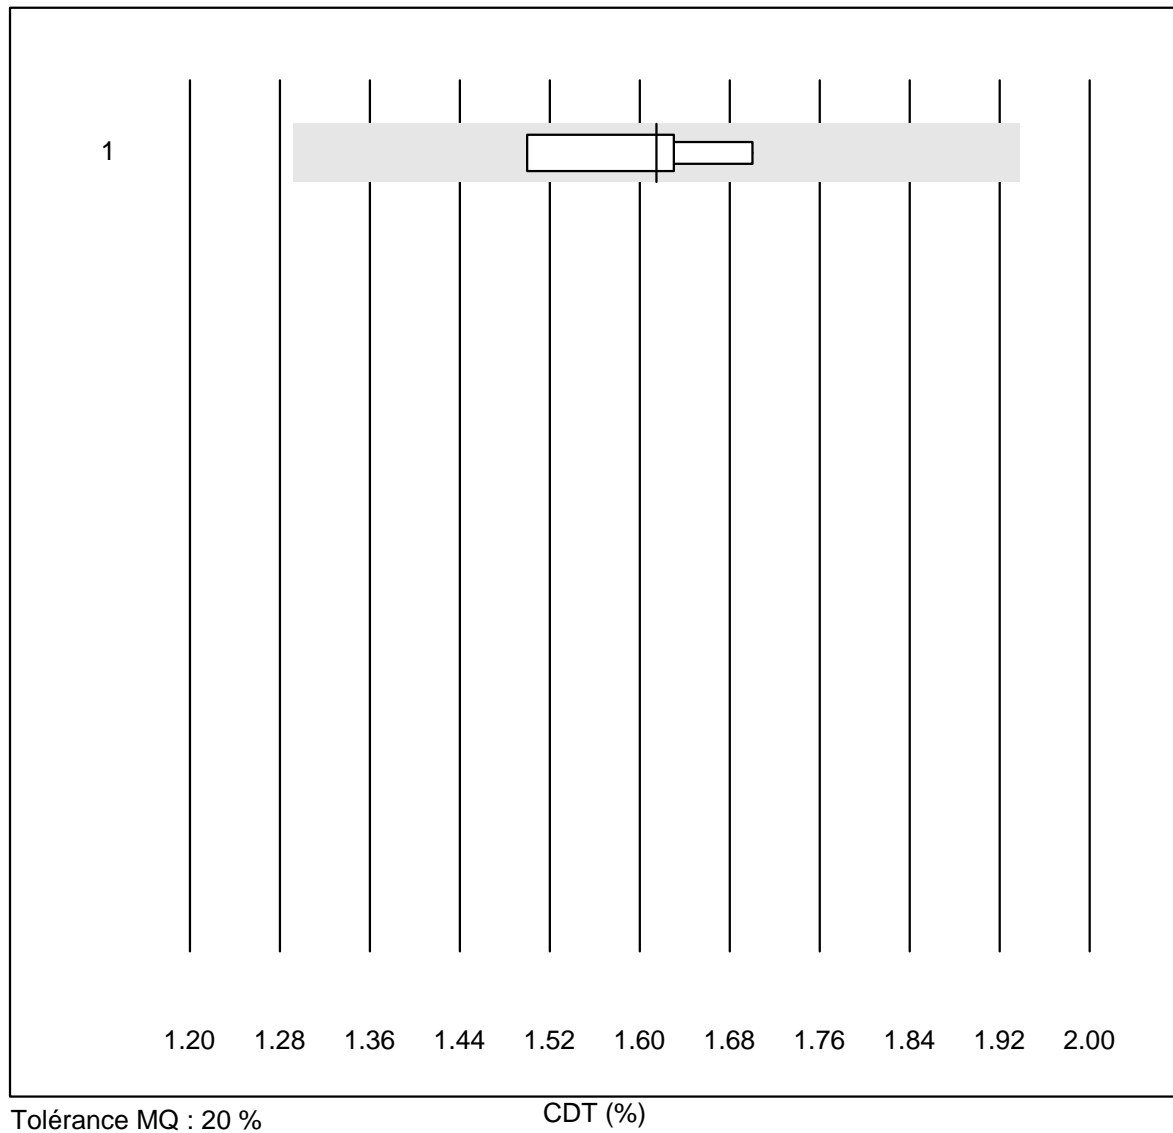


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	1.62	5.2	e*

Tacrolimus

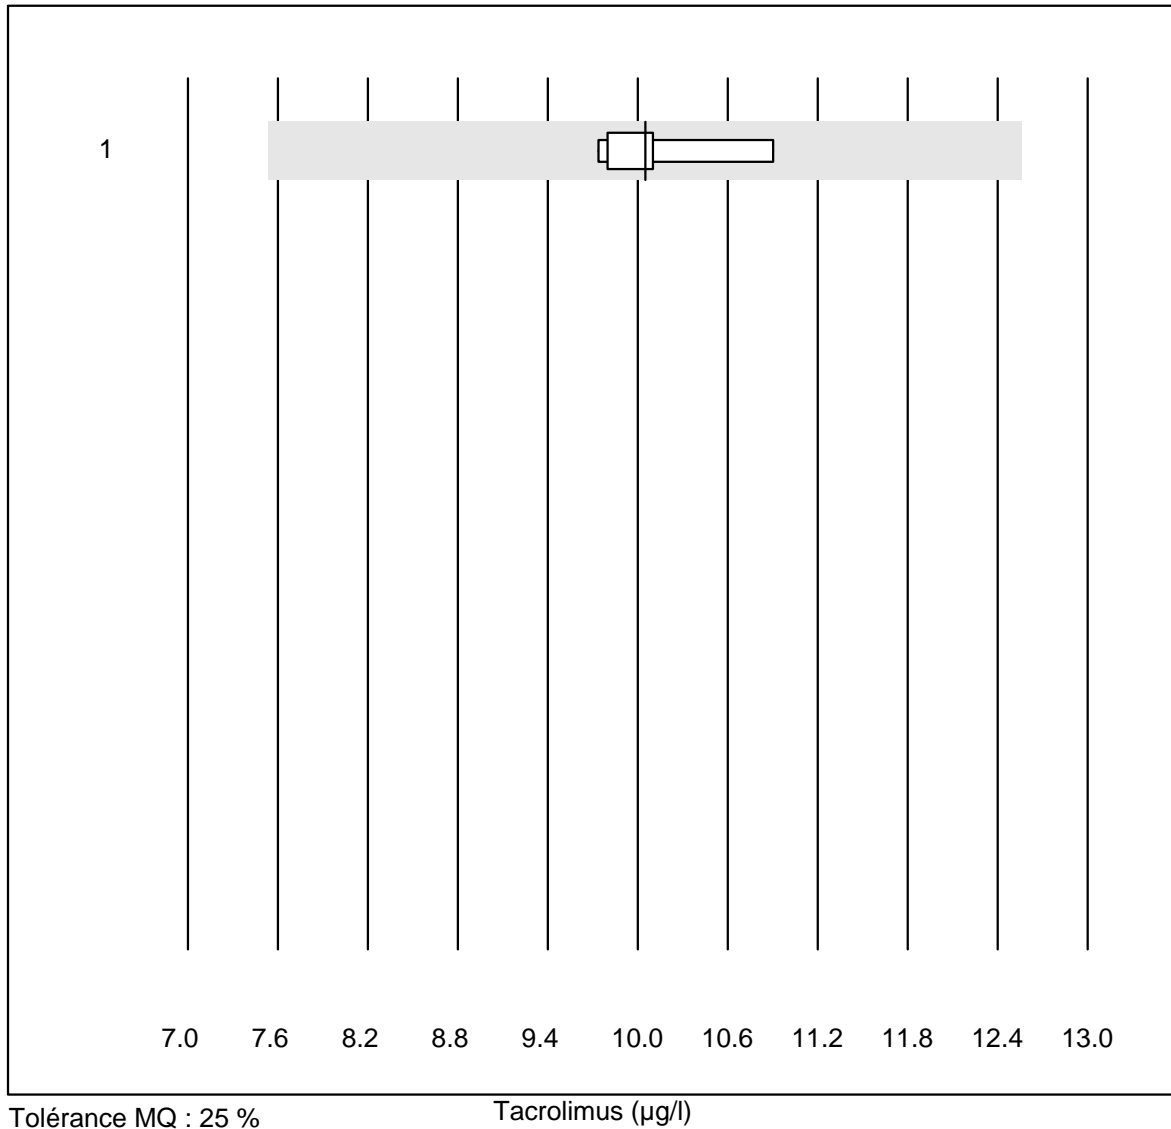

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	8	100.0	0.0	0.0	10.1	3.7	e

Totalprotein E

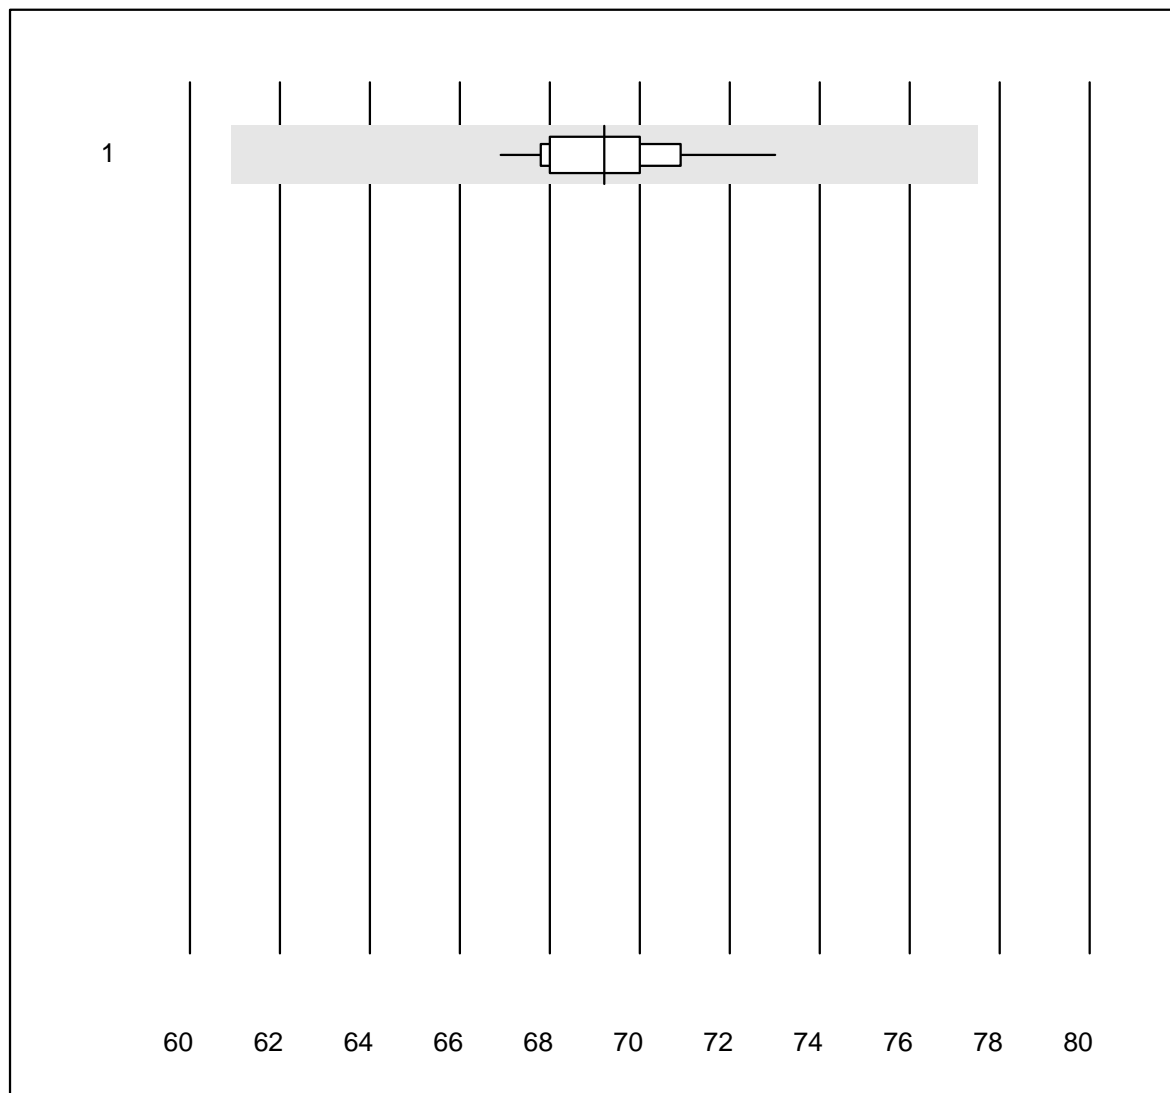


Tolérance MQ : 12 %

Totalprotein E (g/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	11	100.0	0.0	0.0	69.2	2.5	e

Albumin E

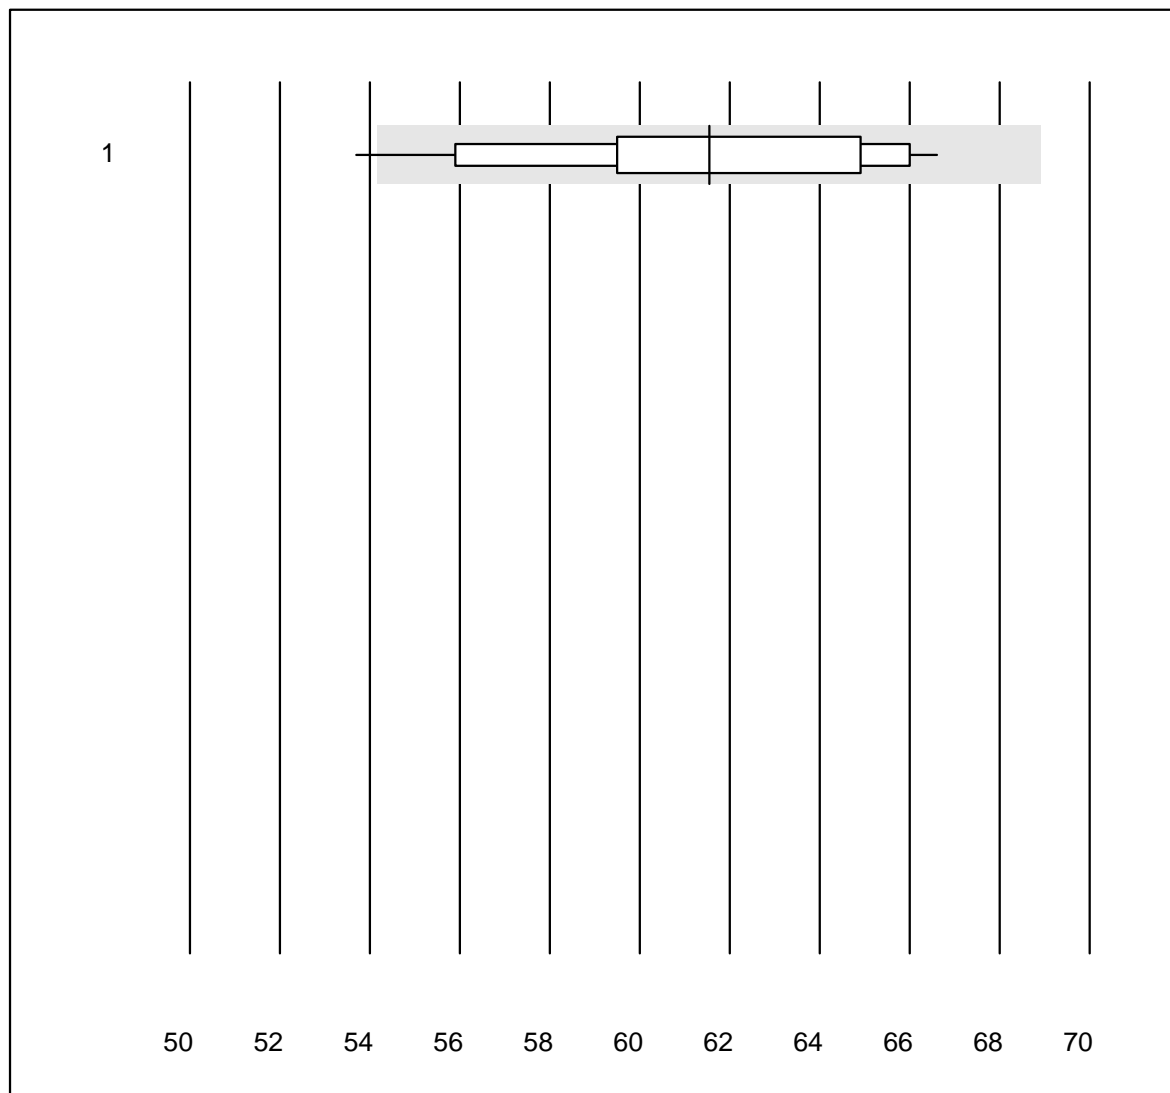


Tolérance MQ : 12 %

Albumin E (%)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 électrophorèse	18	94.4	5.6	0.0	61.5	5.9	e

alpha-1-Globuline

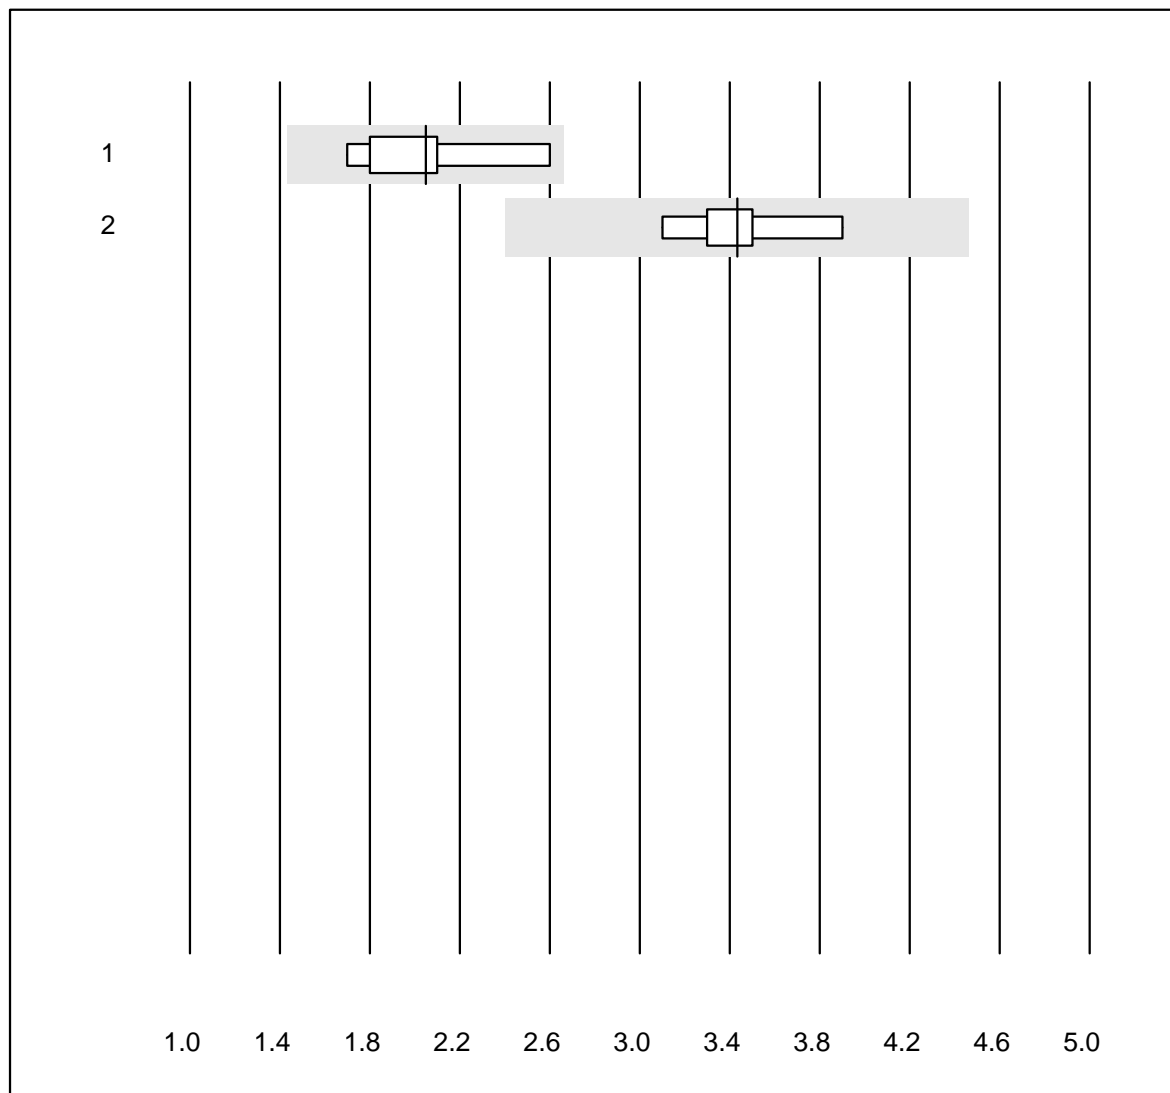


Tolérance MQ : 30 %

alpha-1-Globuline (%)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 électrophorèse	8	100.0	0.0	0.0	2.1	15.2	e*
2 électrophorèse capil	10	90.0	0.0	10.0	3.4	7.0	e

alpha-2-Globuline

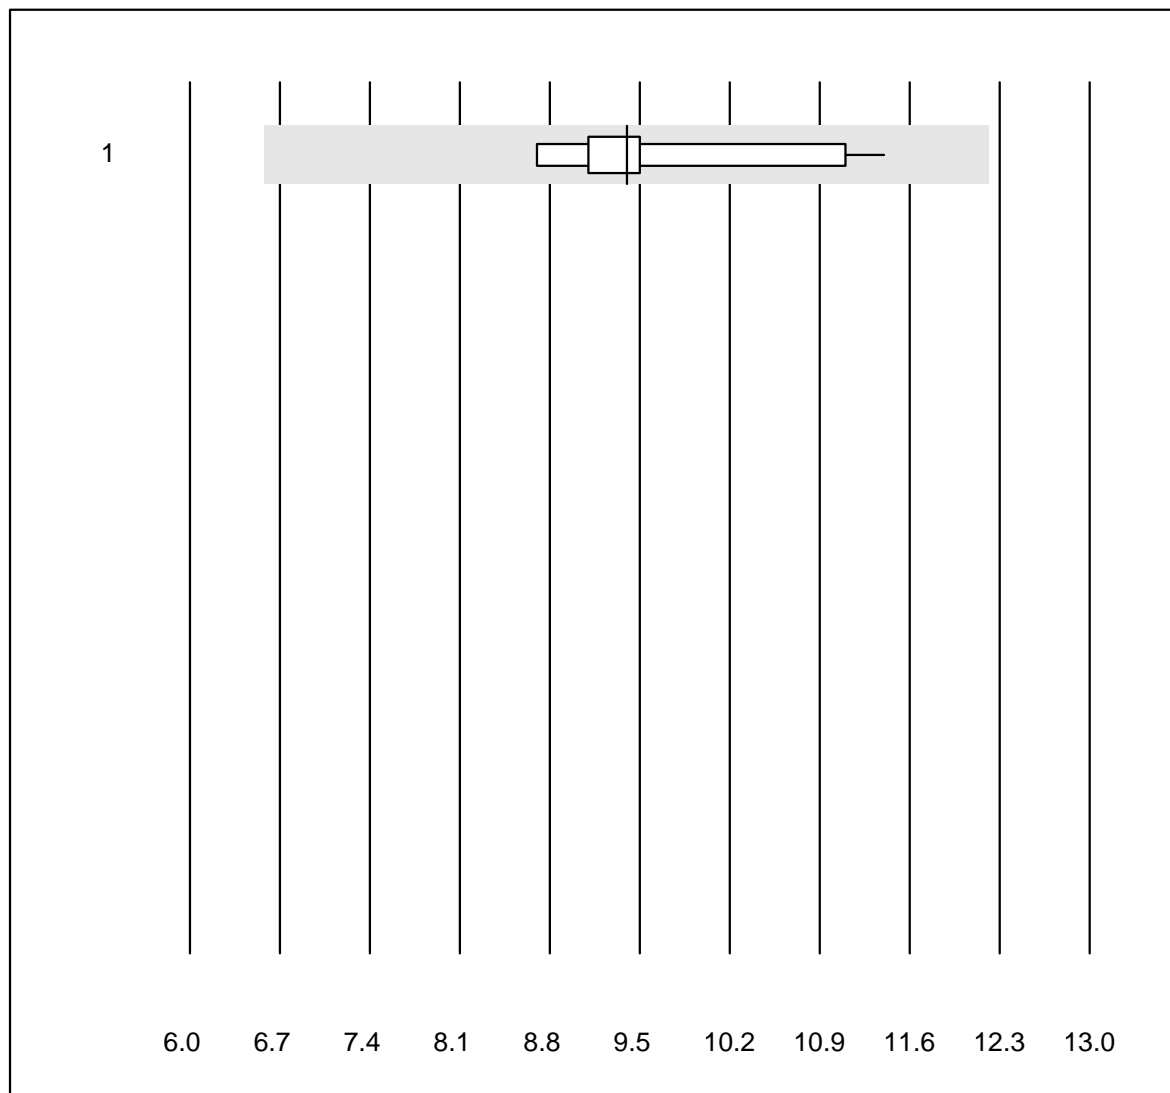


Tolérance MQ : 30 %

alpha-2-Globuline (%)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 électrophorèse	18	100.0	0.0	0.0	9.4	7.8	e

beta-Globuline

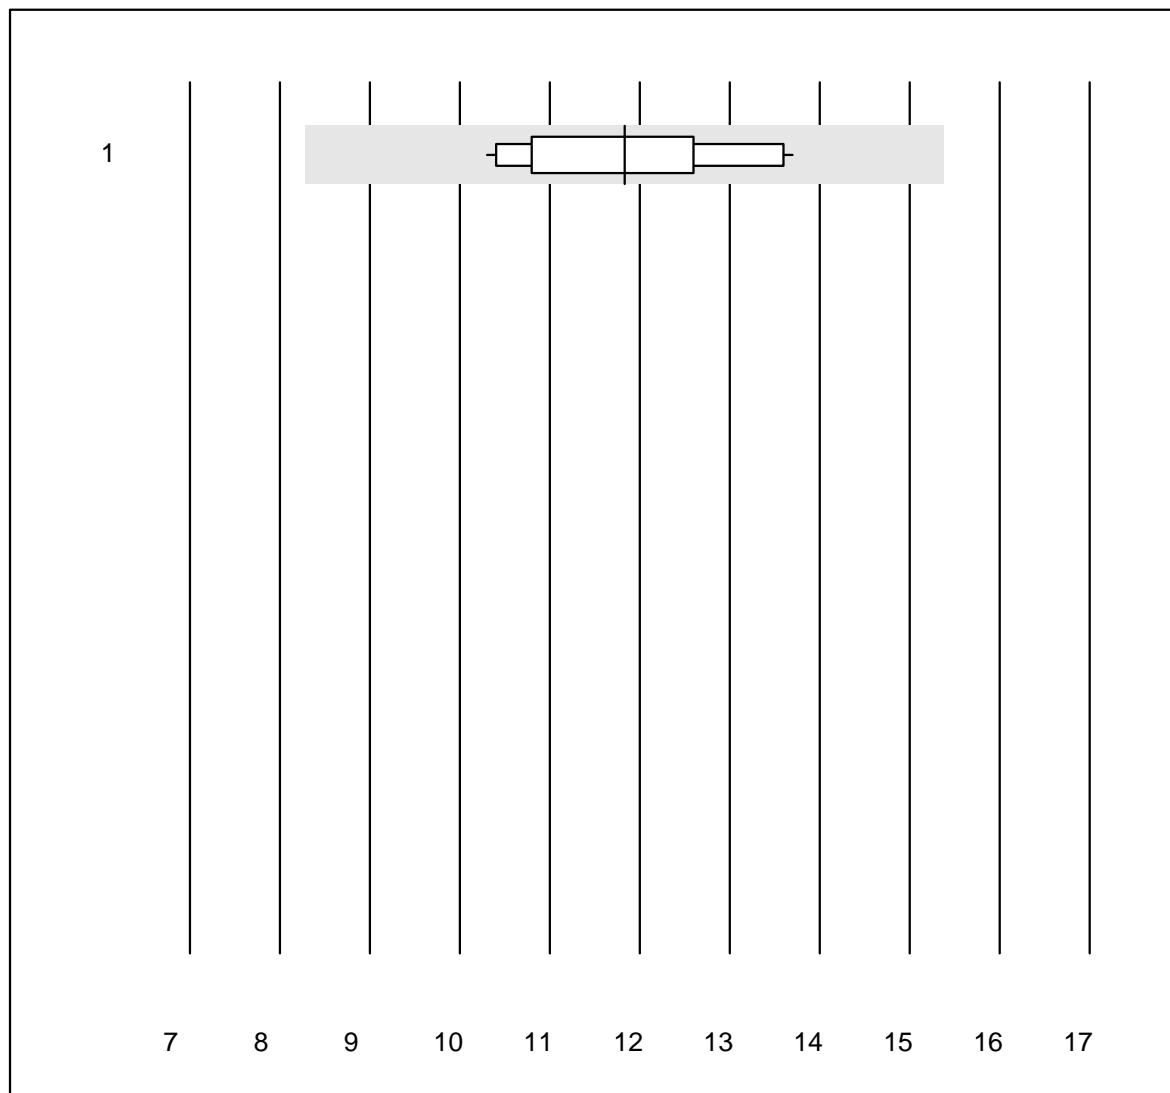


Tolérance MQ : 30 %

beta-Globuline (%)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 électrophorèse	16	100.0	0.0	0.0	11.8	9.4	e

Beta-1-Globulin

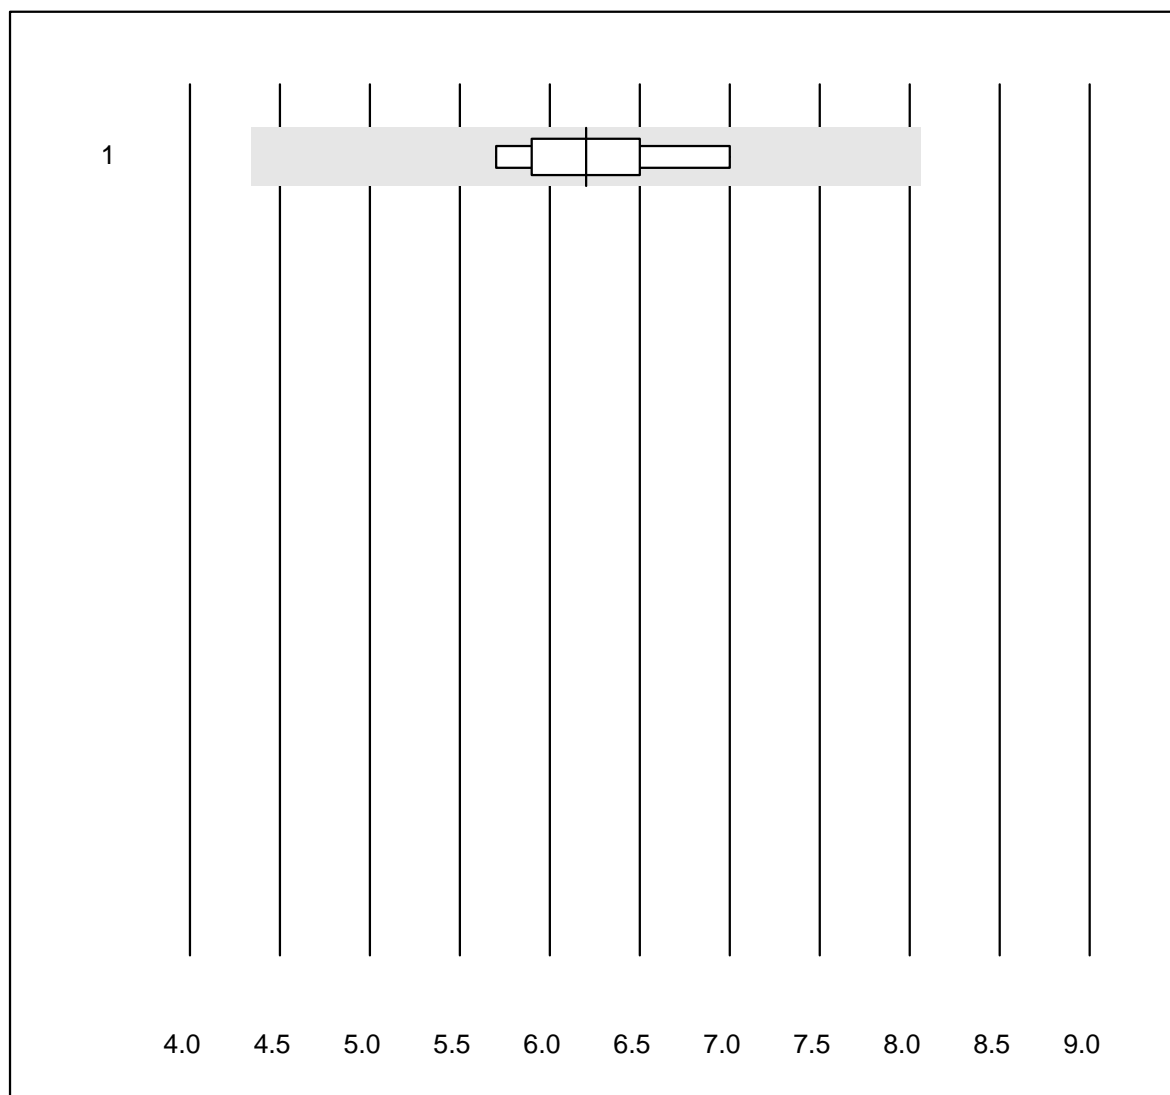


Tolérance MQ : 30 %

Beta-1-Globulin (%)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 électrophorèse	5	100.0	0.0	0.0	6.2	8.2	e*

Beta-2-Globulin

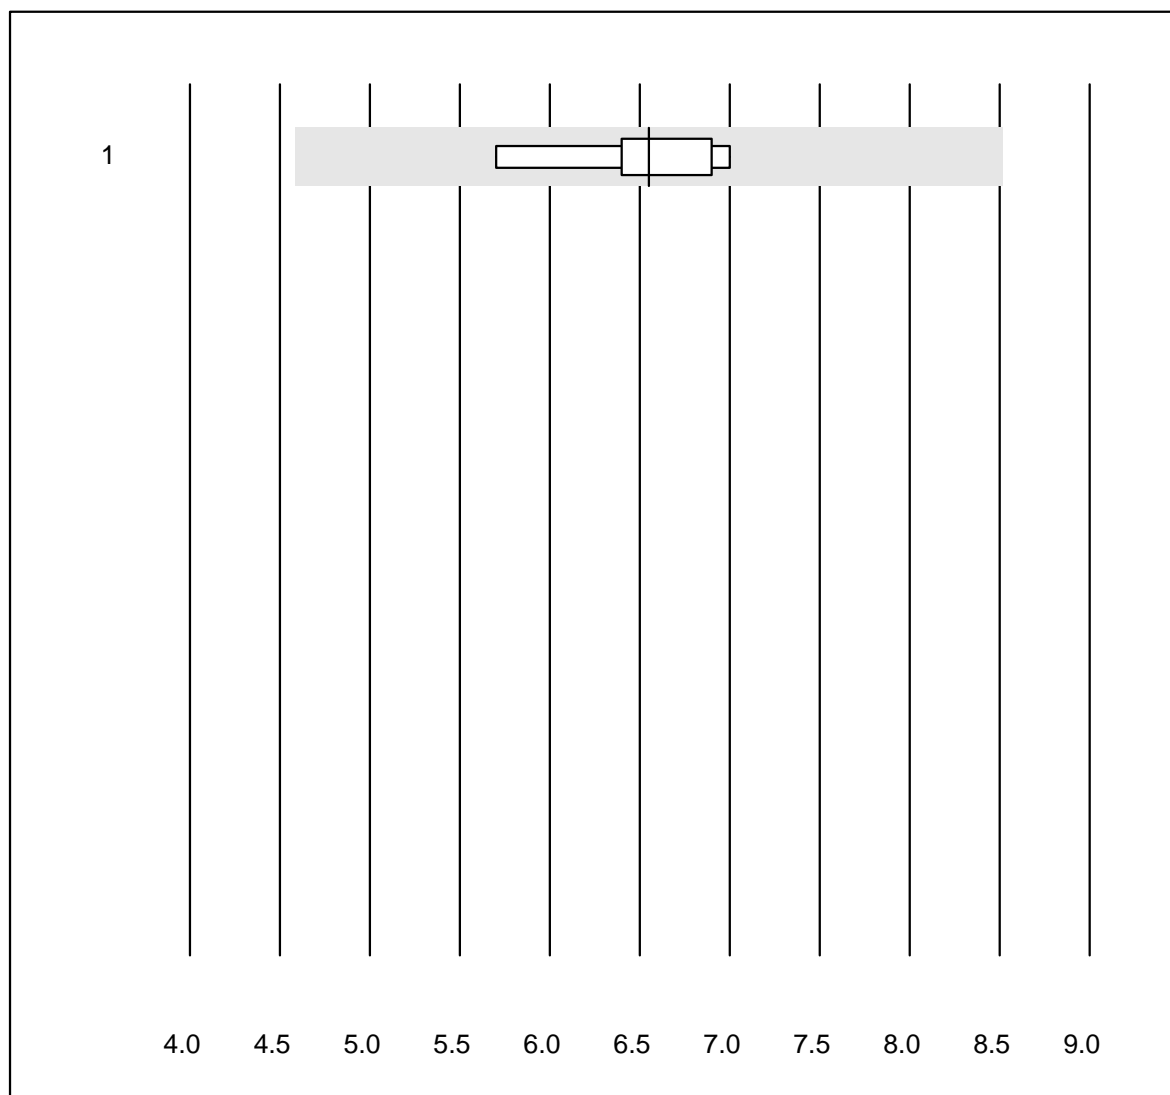


Tolérance MQ : 30 %

Beta-2-Globulin (%)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 électrophorèse	6	100.0	0.0	0.0	6.6	7.1	e

gamma-Globuline

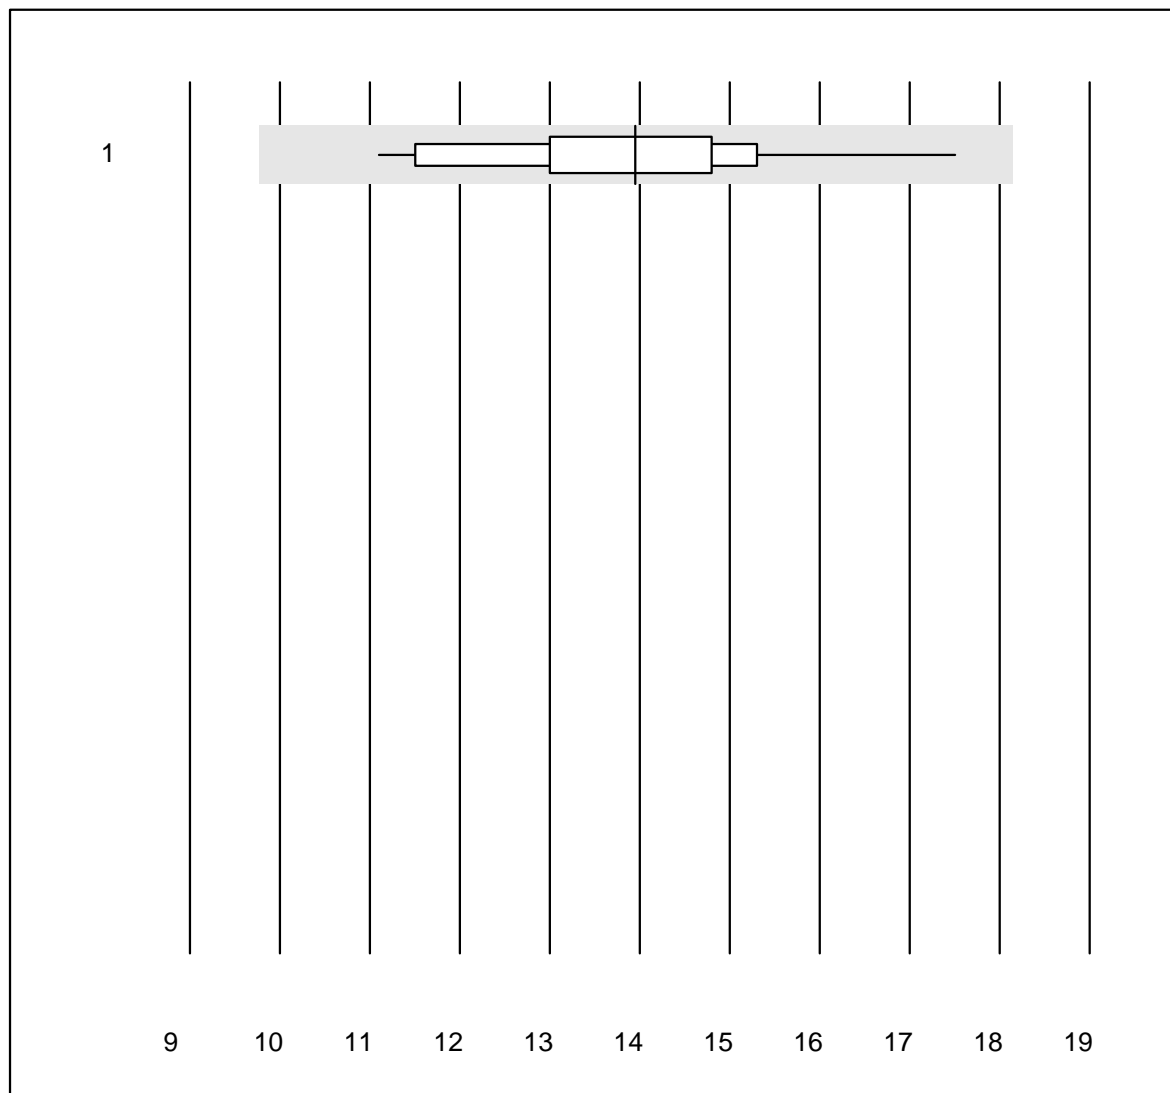


Tolérance MQ : 30 %

gamma-Globuline (%)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 électrophorèse	15	100.0	0.0	0.0	14.0	11.2	e

Immundefixation

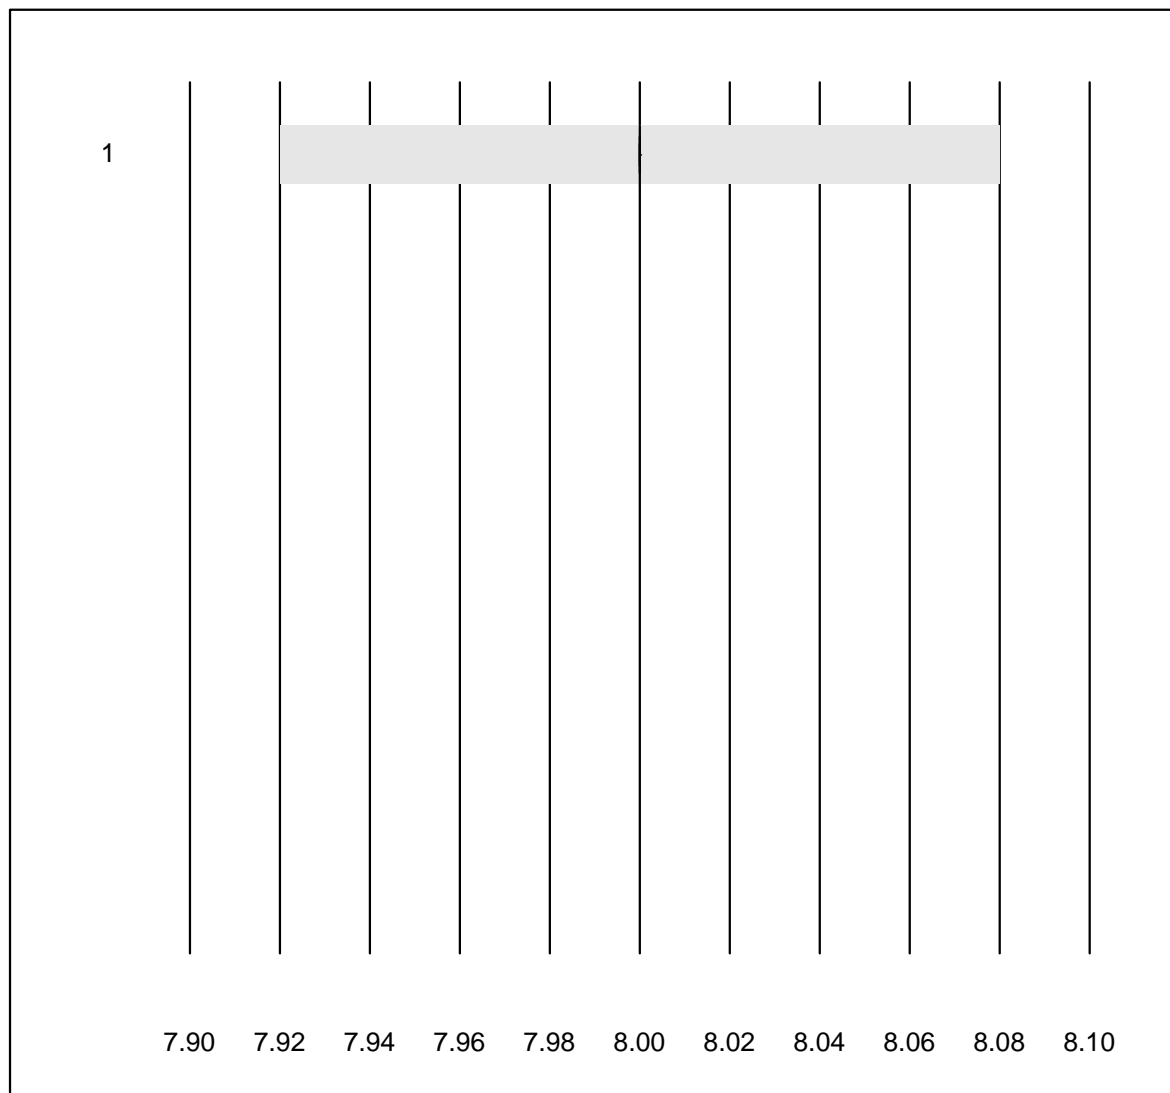


QUALAB Toleranz : 1 %

Immundefixation (Code)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 interprétation	15	100.0	0.0	0.0	8	0.0	e

Folates érythrocytaires

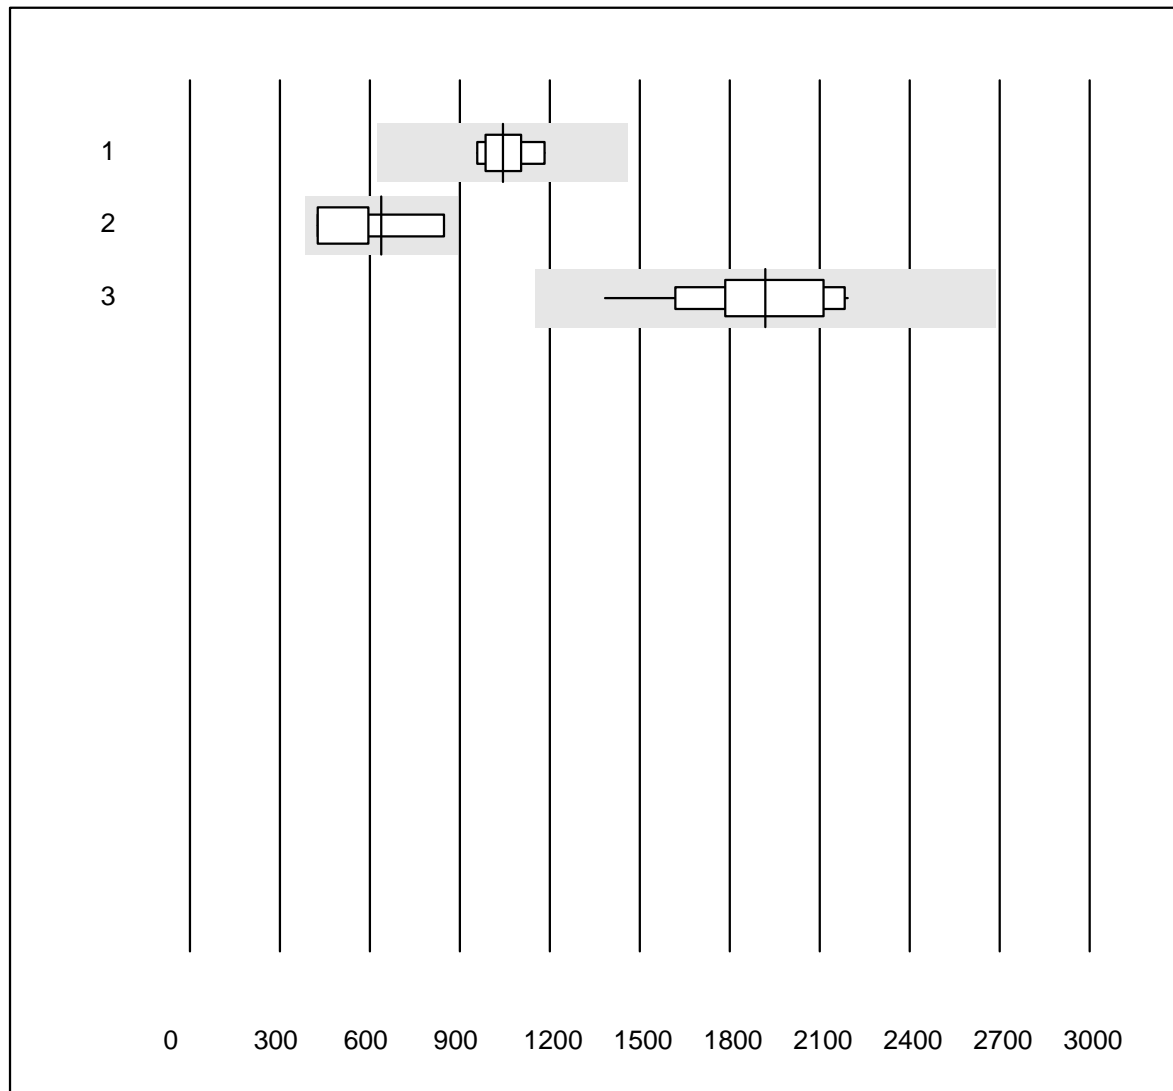


Tolérance MQ : 40 %

Folates érythrocytaires (nmol/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Alinity	6	100.0	0.0	0.0	1043	7.9	e
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	637	30.3	a
3 Cobas	12	100.0	0.0	0.0	1919	13.2	e

Gallensäure

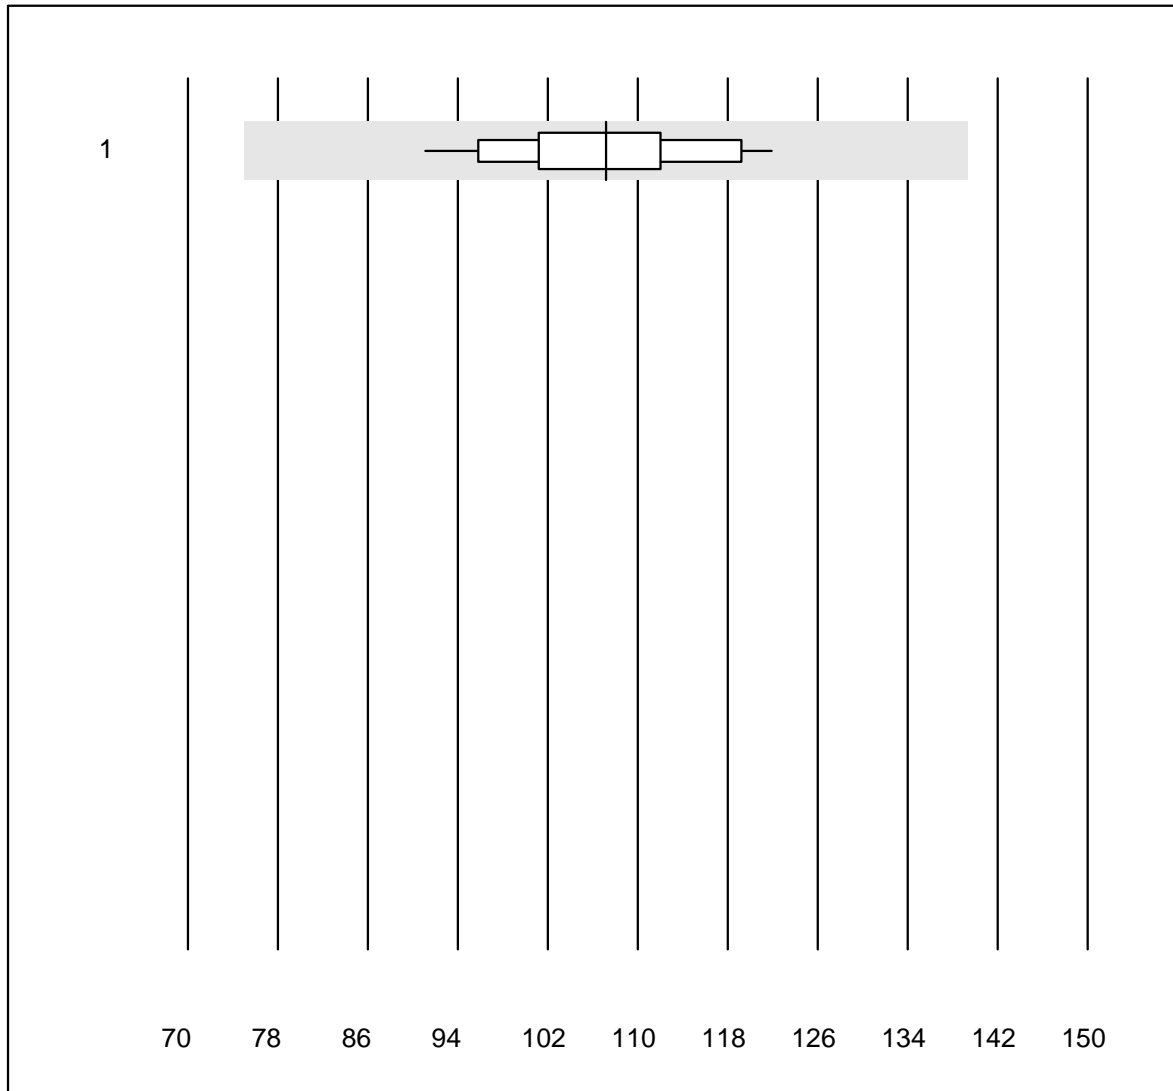


Tolérance MQ : 30 %

Gallensäure (µmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	13	100.0	0.0	0.0	107.1	8.6	e

BNP

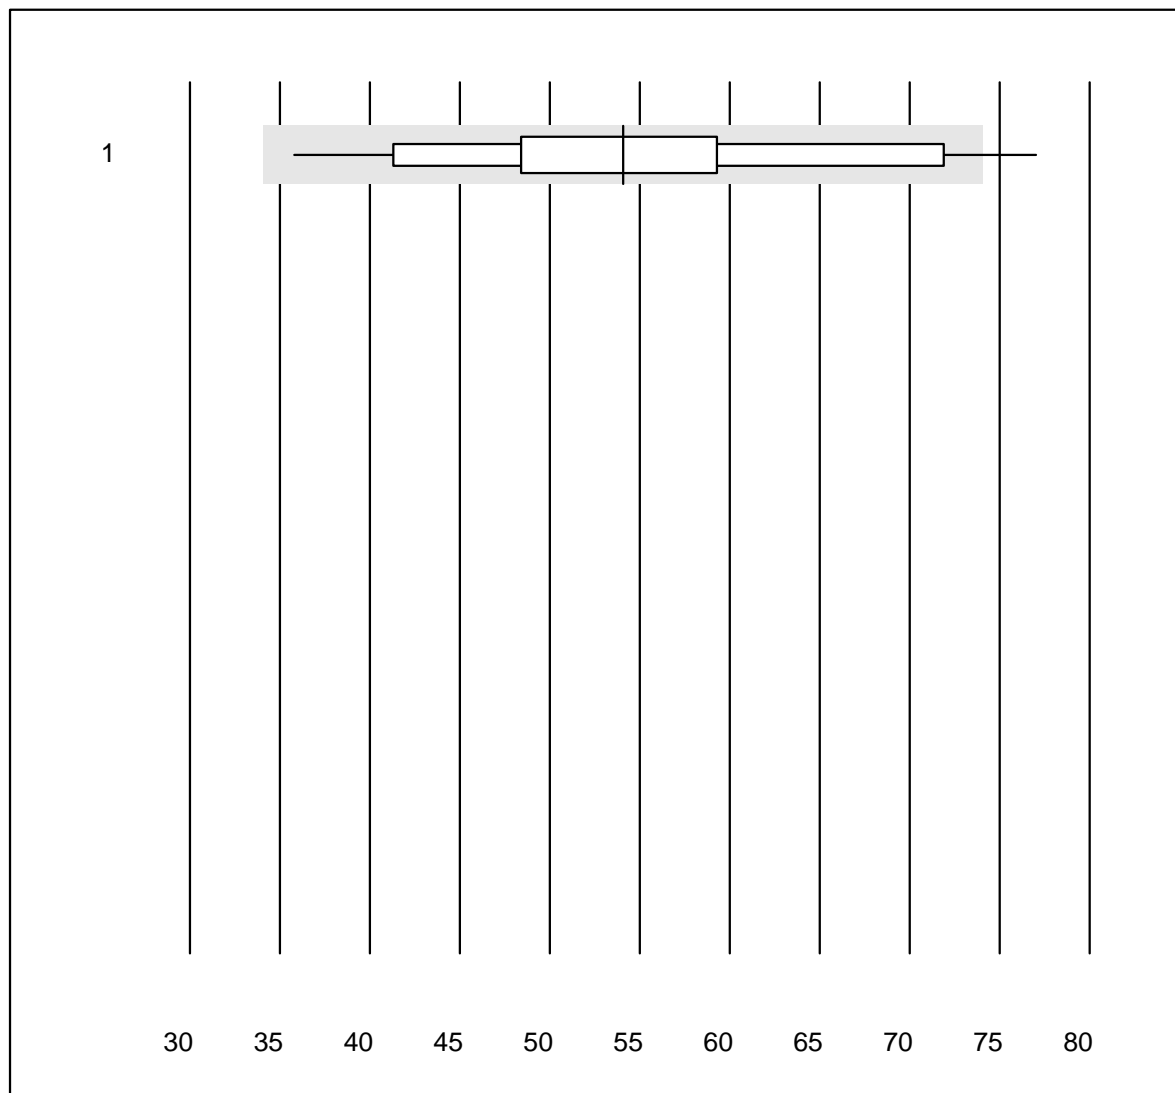


QUALAB Toleranz : 27 %
 (< 75.0: +/- 20.0 ng/l)

BNP (ng/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Triage	20	90.0	5.0	5.0	54.1	18.5	e*

Troponin Triage

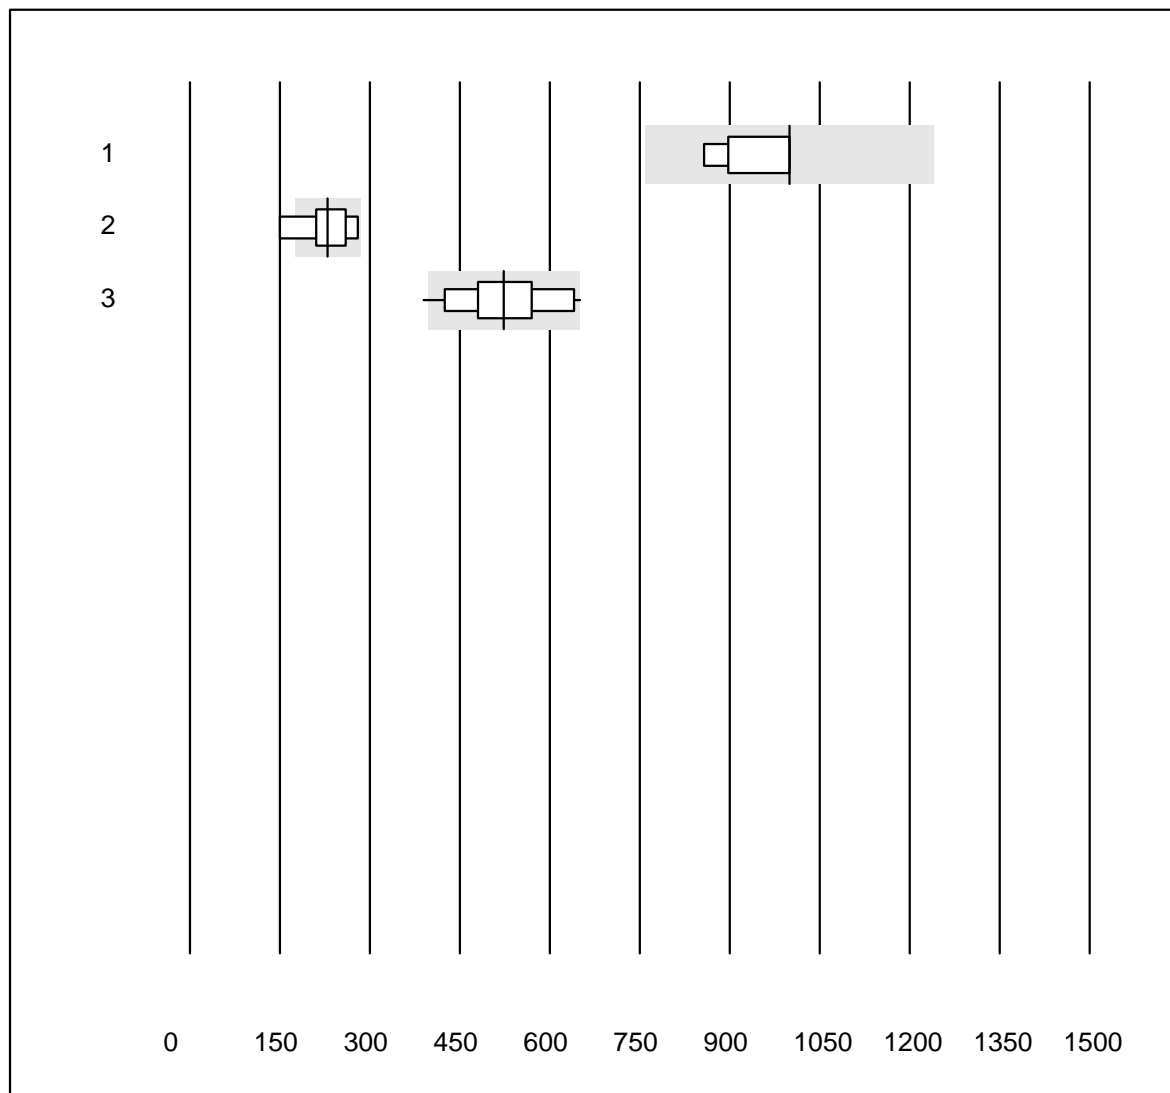


QUALAB Toleranz : 24 %

Troponin Triage (ng/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Triage high sensitiv	7	100.0	0.0	0.0	1000.00	6.3	e
2	Triage SOB/Cardiac	8	62.5	12.5	25.0	230.00	20.0	a
3	Triage Next Gen	19	79.0	10.5	10.5	523.24	14.4	e*

NT-pro BNP

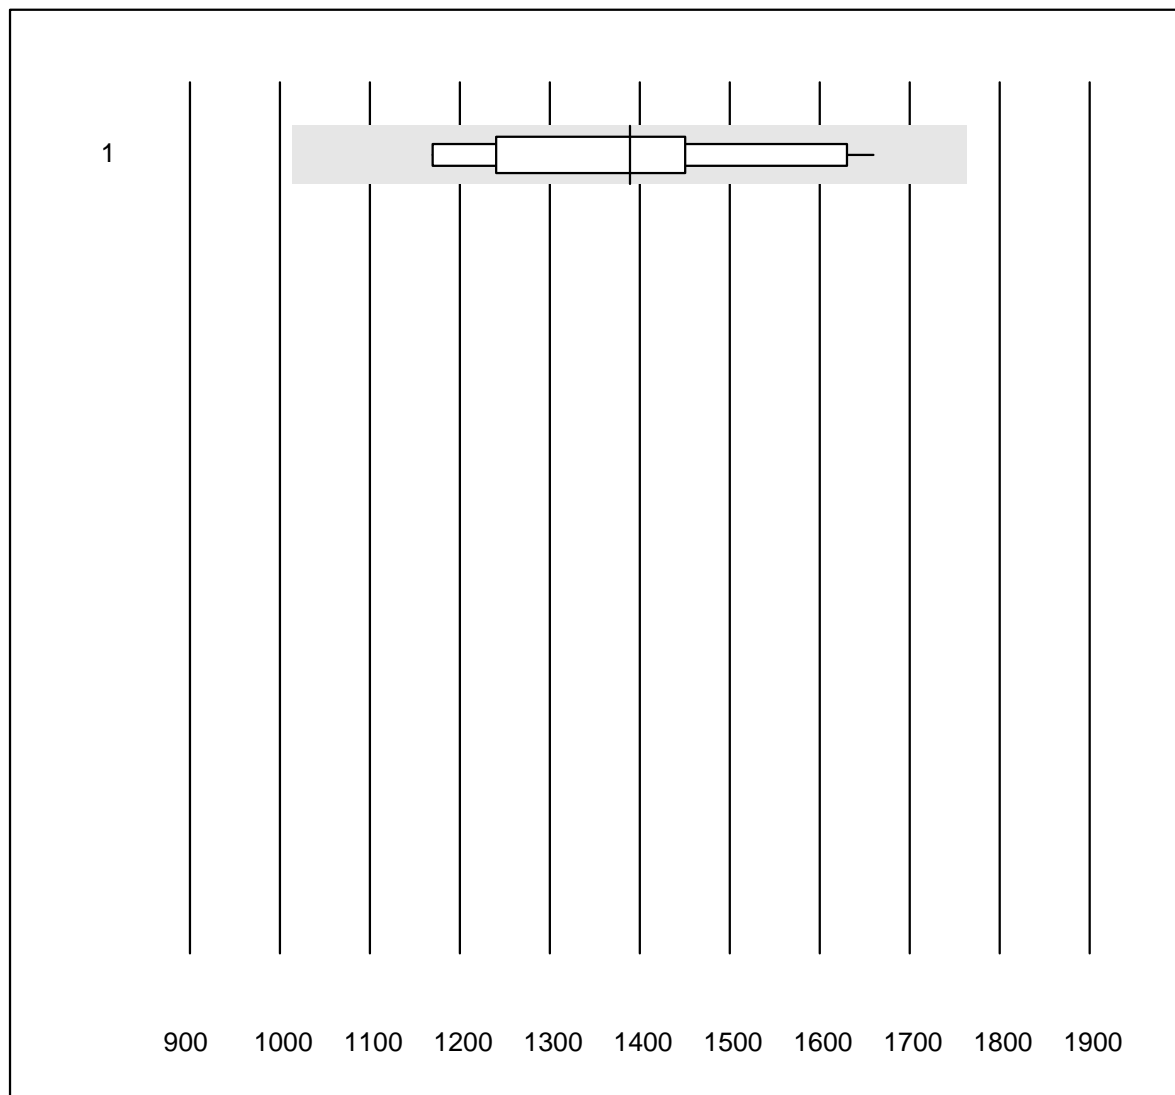


QUALAB Toleranz : 27 %

NT-pro BNP (ng/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Triage	10	100.0	0.0	0.0	1389	12.2	e*

D-Dimere Triage

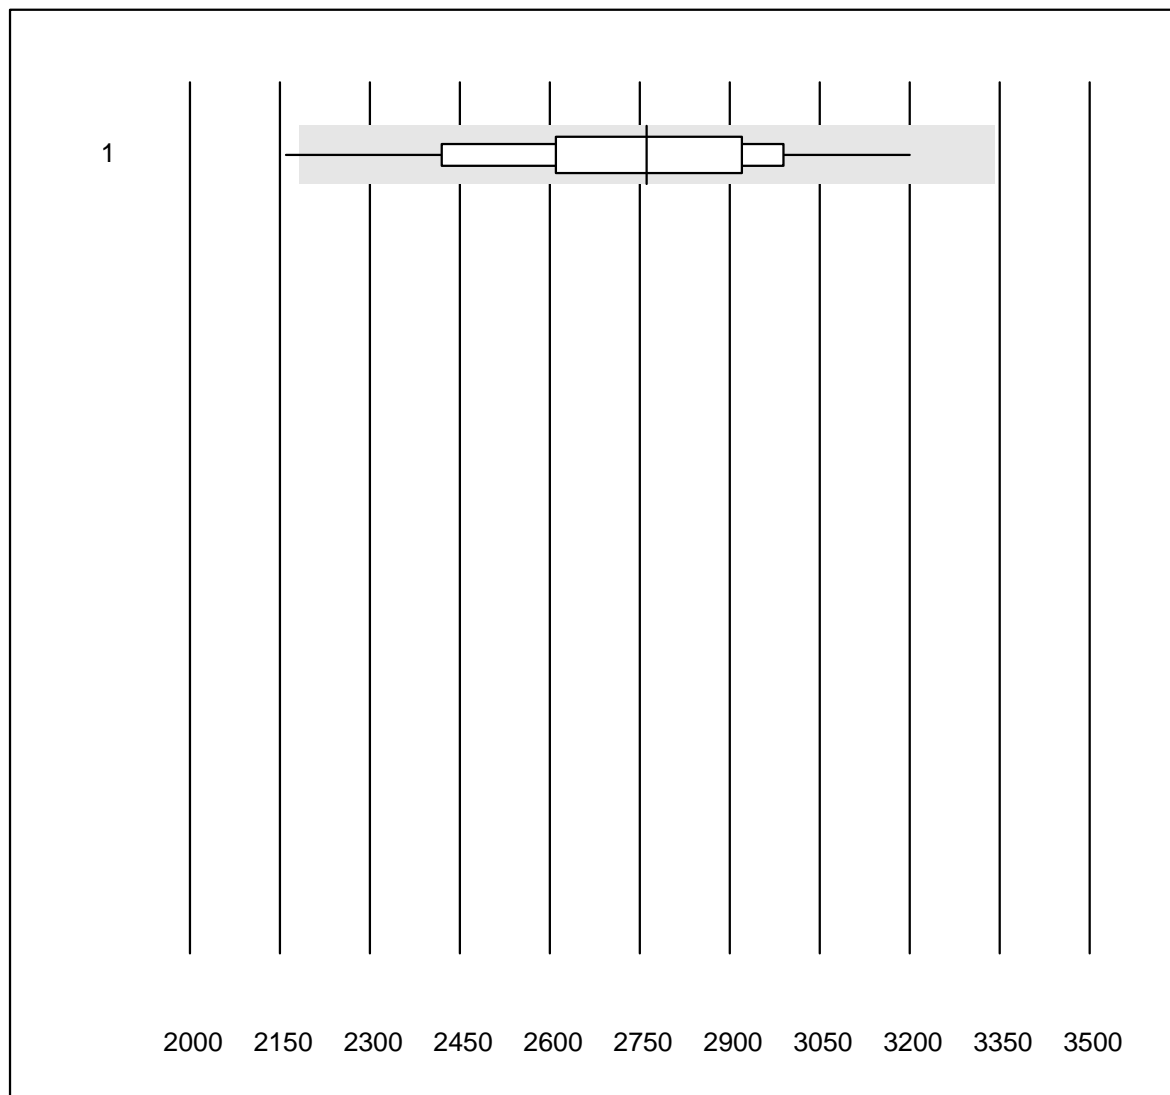


QUALAB Toleranz : 21 %

D-Dimere Triage (ng/ml)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Triage	34	97.1	2.9	0.0	2760.88	9.0	e

CK-MB Triage

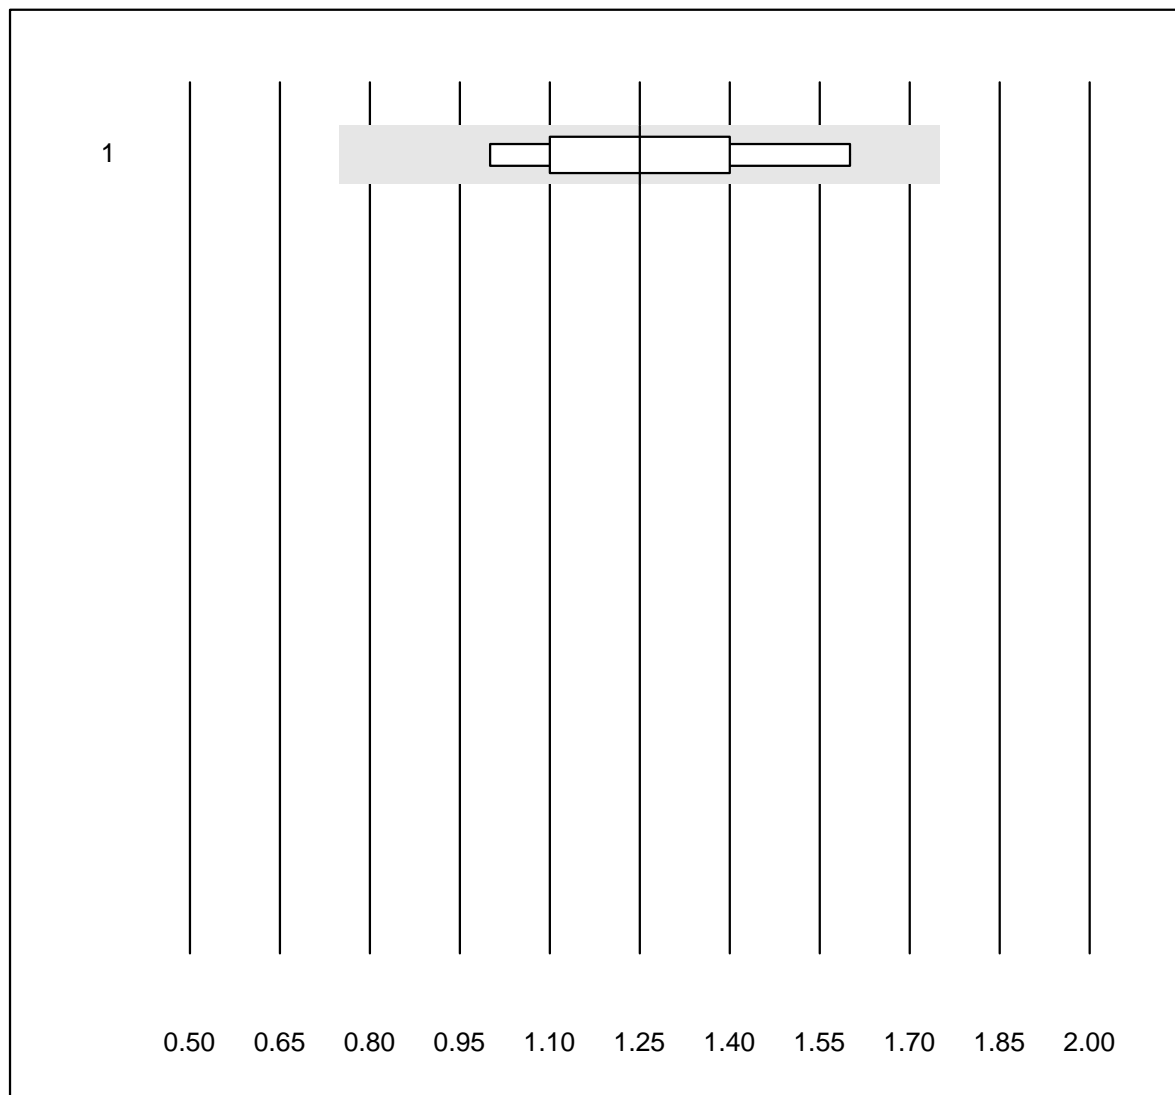


Tolérance MQ : 40 %

CK-MB Triage (µg/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Triage	8	100.0	0.0	0.0	1.3	17.8	e*

Myoglobin Triage

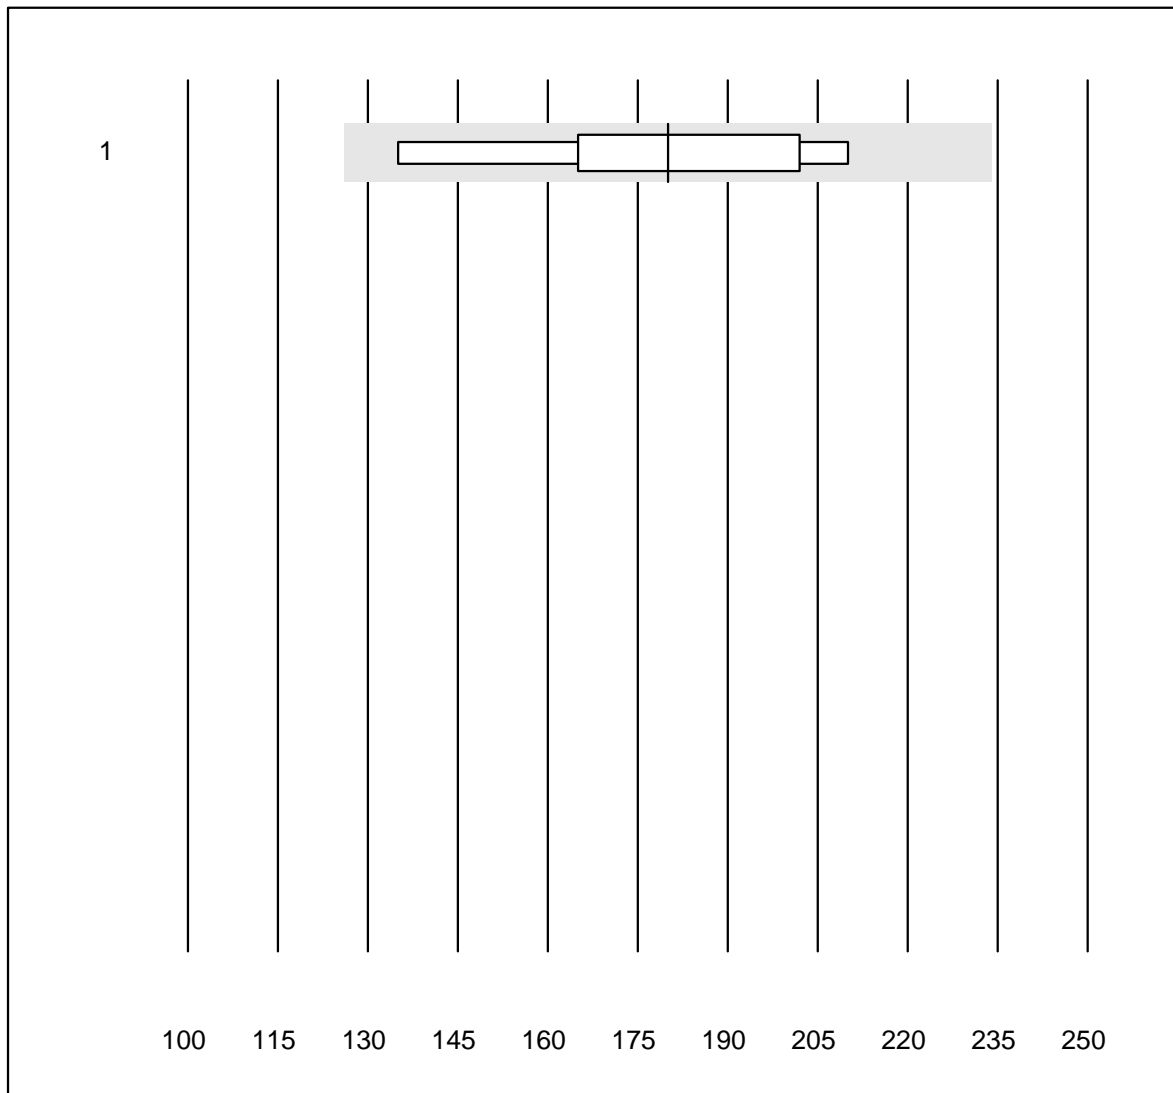


QUALAB Toleranz : 30 %

Myoglobin Triage (µg/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Triage	8	100.0	0.0	0.0	180.0	13.5	e*

Vitamine D 25 (OH)

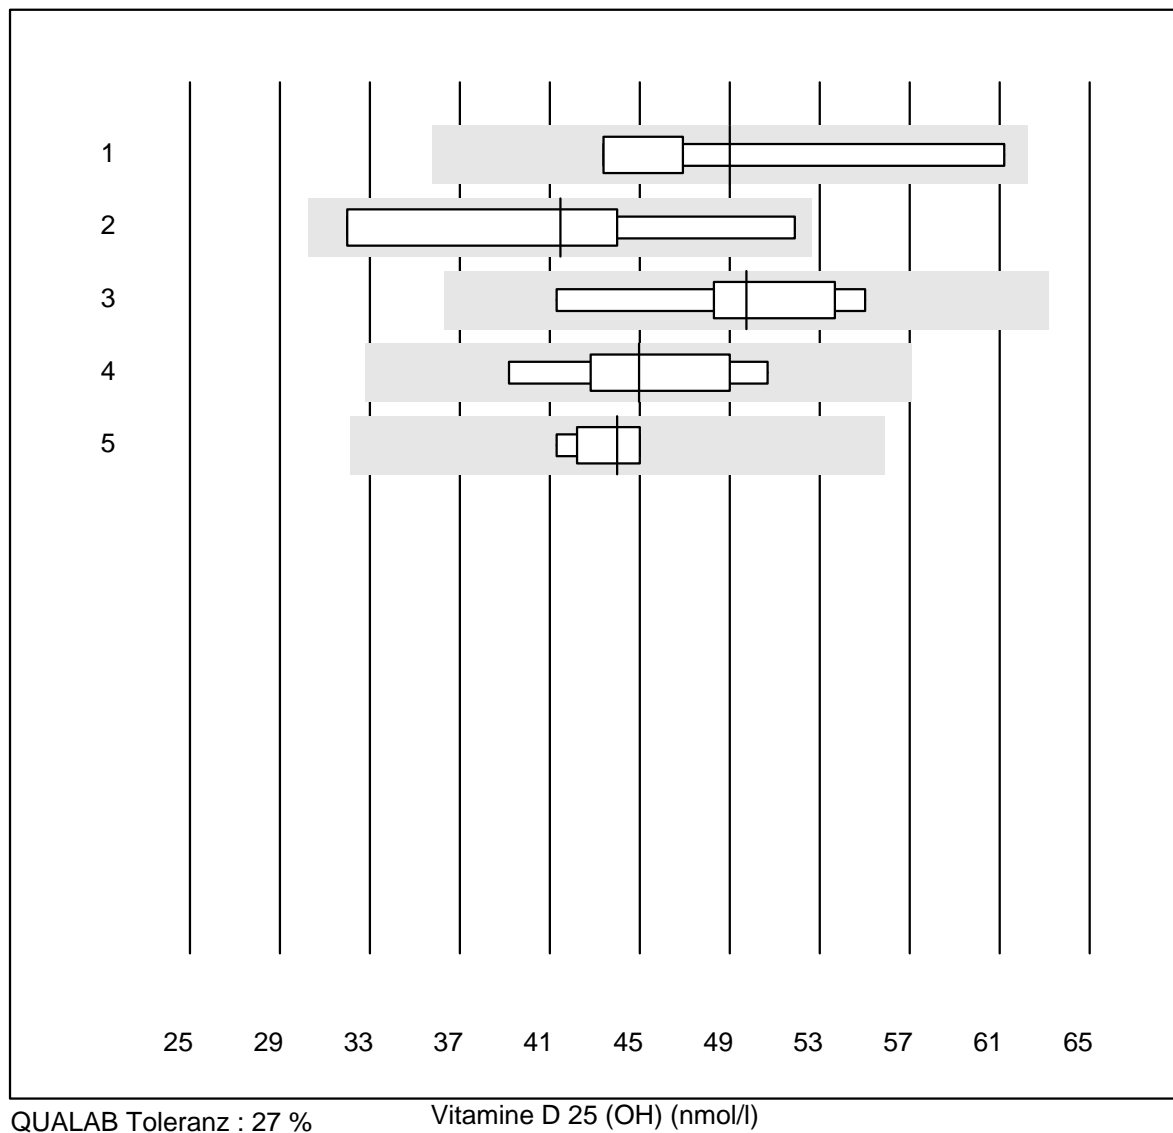


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 LCMS	4	100.0	0.0	0.0	49.0	15.9	a
2 Cobas	9	88.9	0.0	11.1	41.5	16.1	e*
3 VIDAS	6	100.0	0.0	0.0	49.7	9.7	e*
4 Autres méthodes	7	100.0	0.0	0.0	45.0	8.5	e
5 Architect	9	100.0	0.0	0.0	44.0	3.3	e

AMH

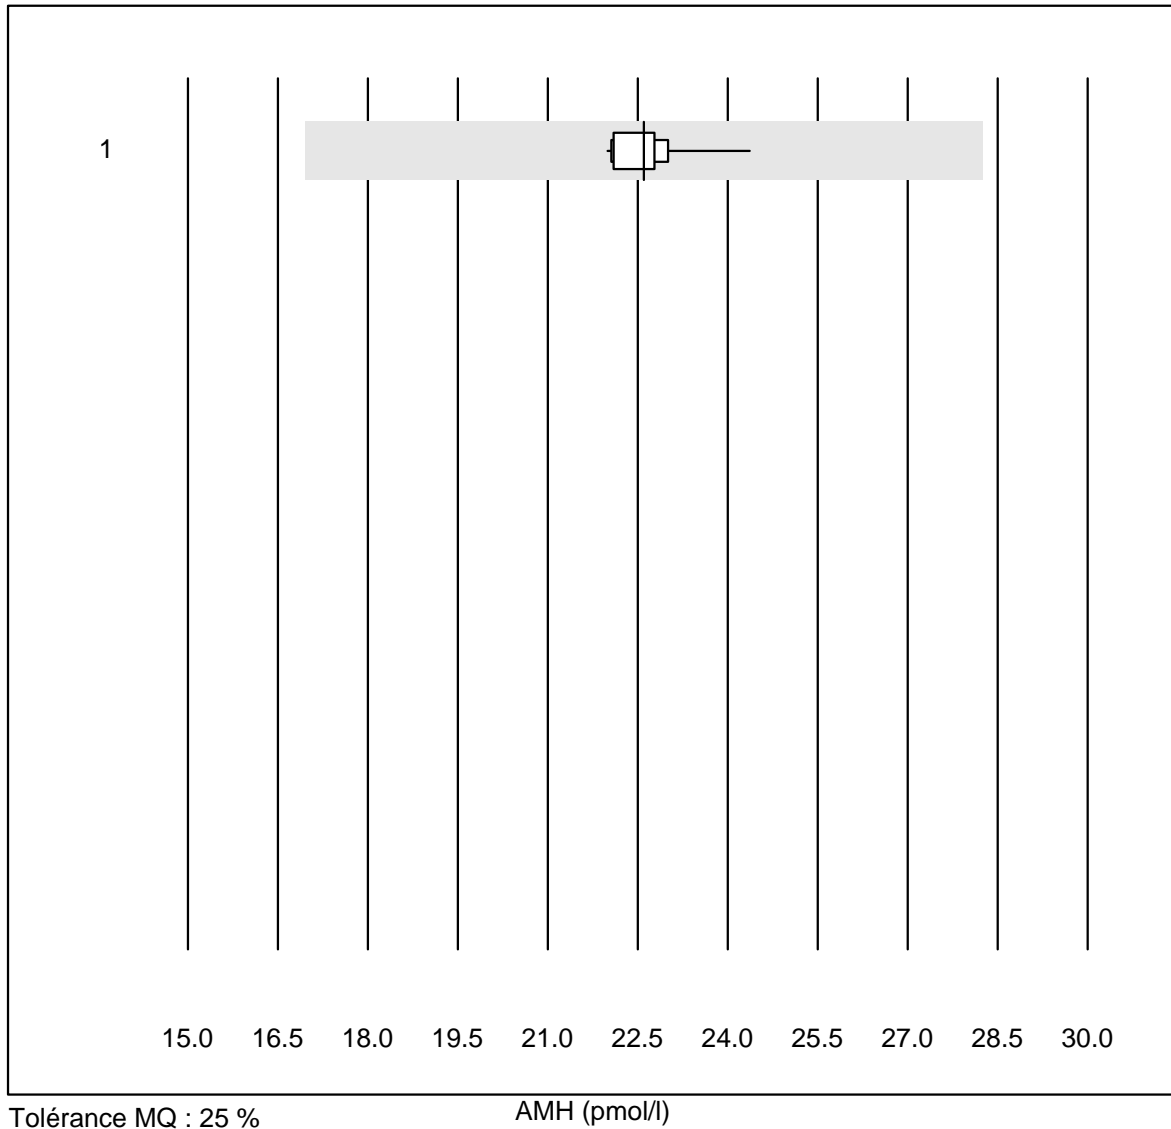


Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	11	100.0	0.0	0.0	22.6	3.0	e

Calcitonin

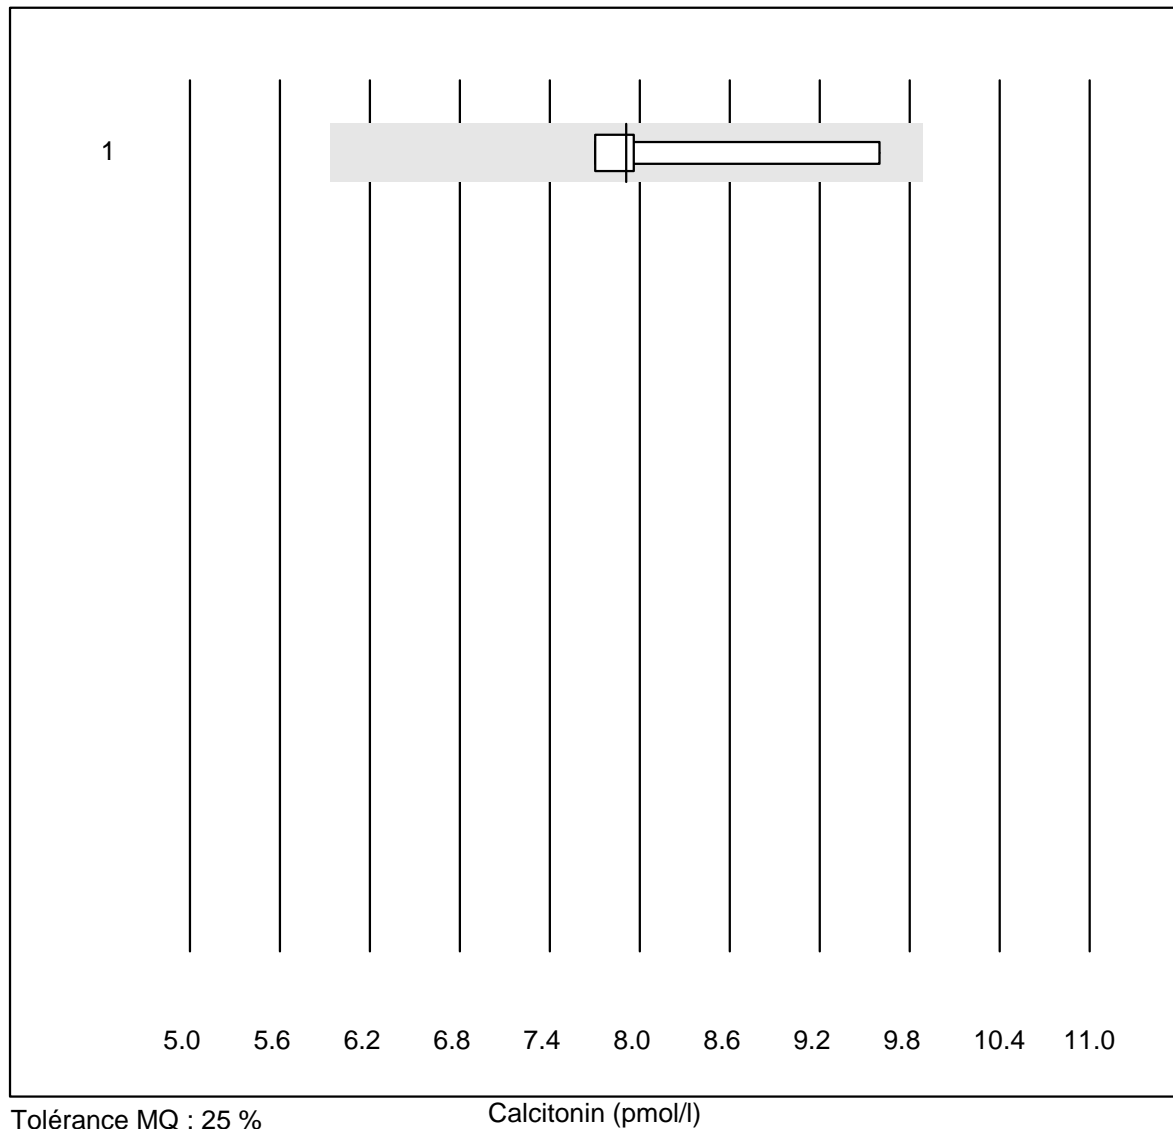


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	7.9	10.7	e*

IGF-BP3

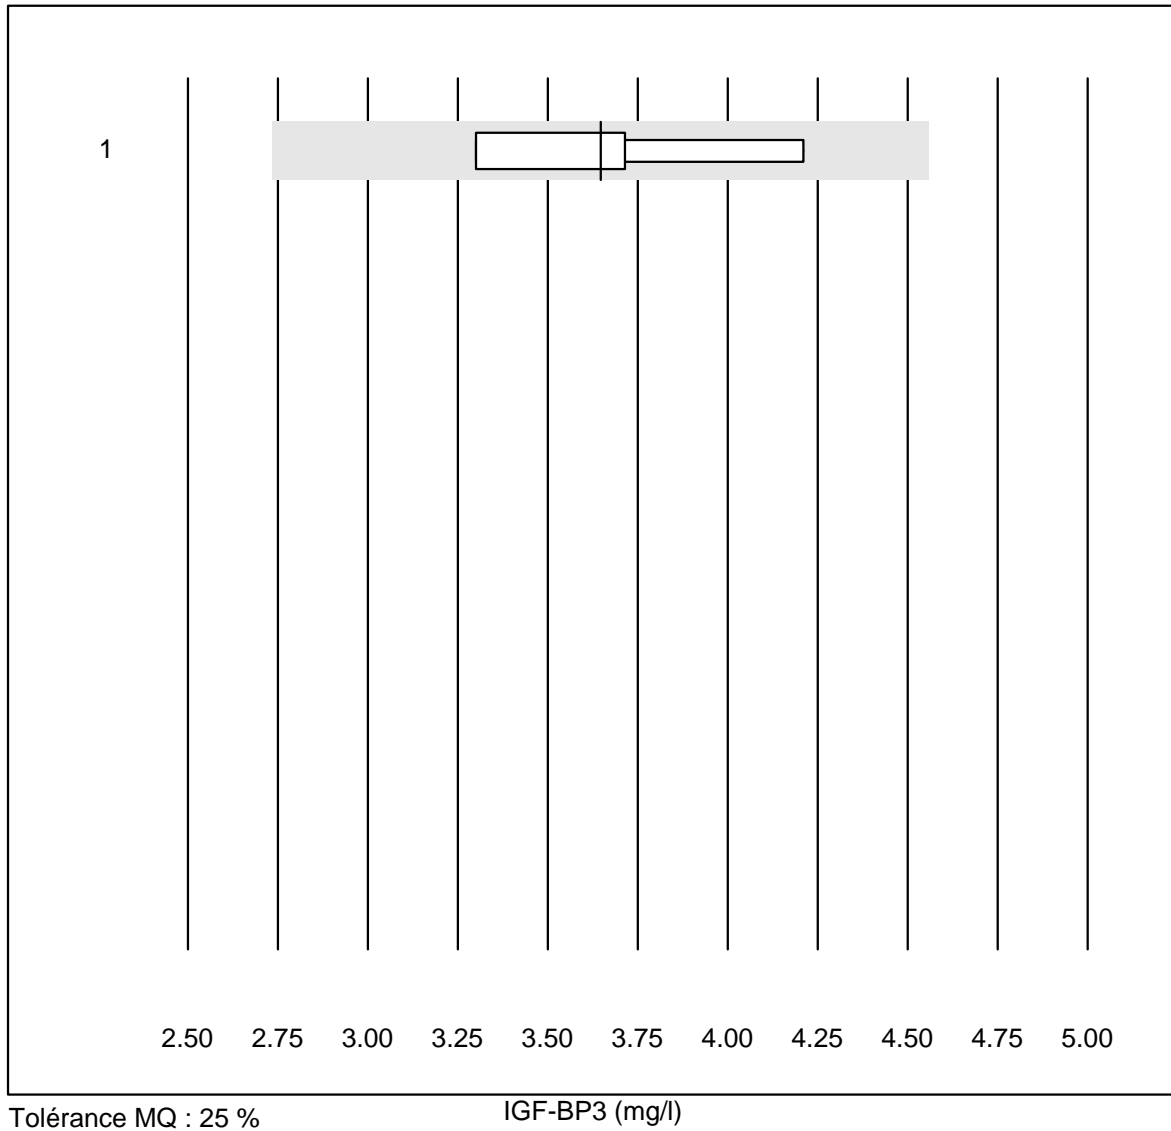

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	3.65	10.3	e*

Anti Thyreoglobulin

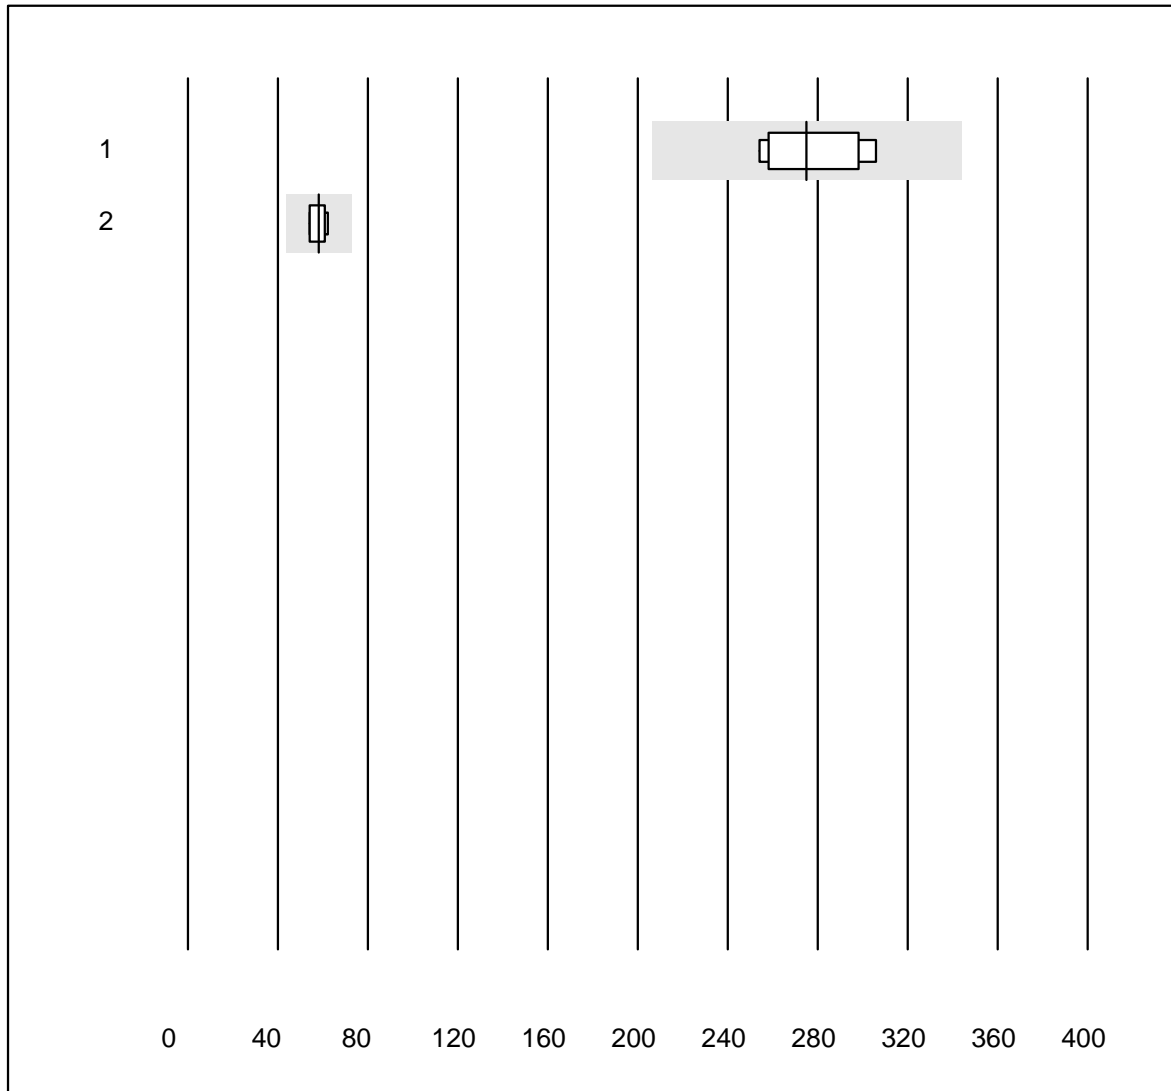


Tolérance MQ : 25 %

Anti Thyreoglobulin (IU/ml)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	7	100.0	0.0	0.0	275	7.7	a
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	58	6.8	e*

Anti TPO

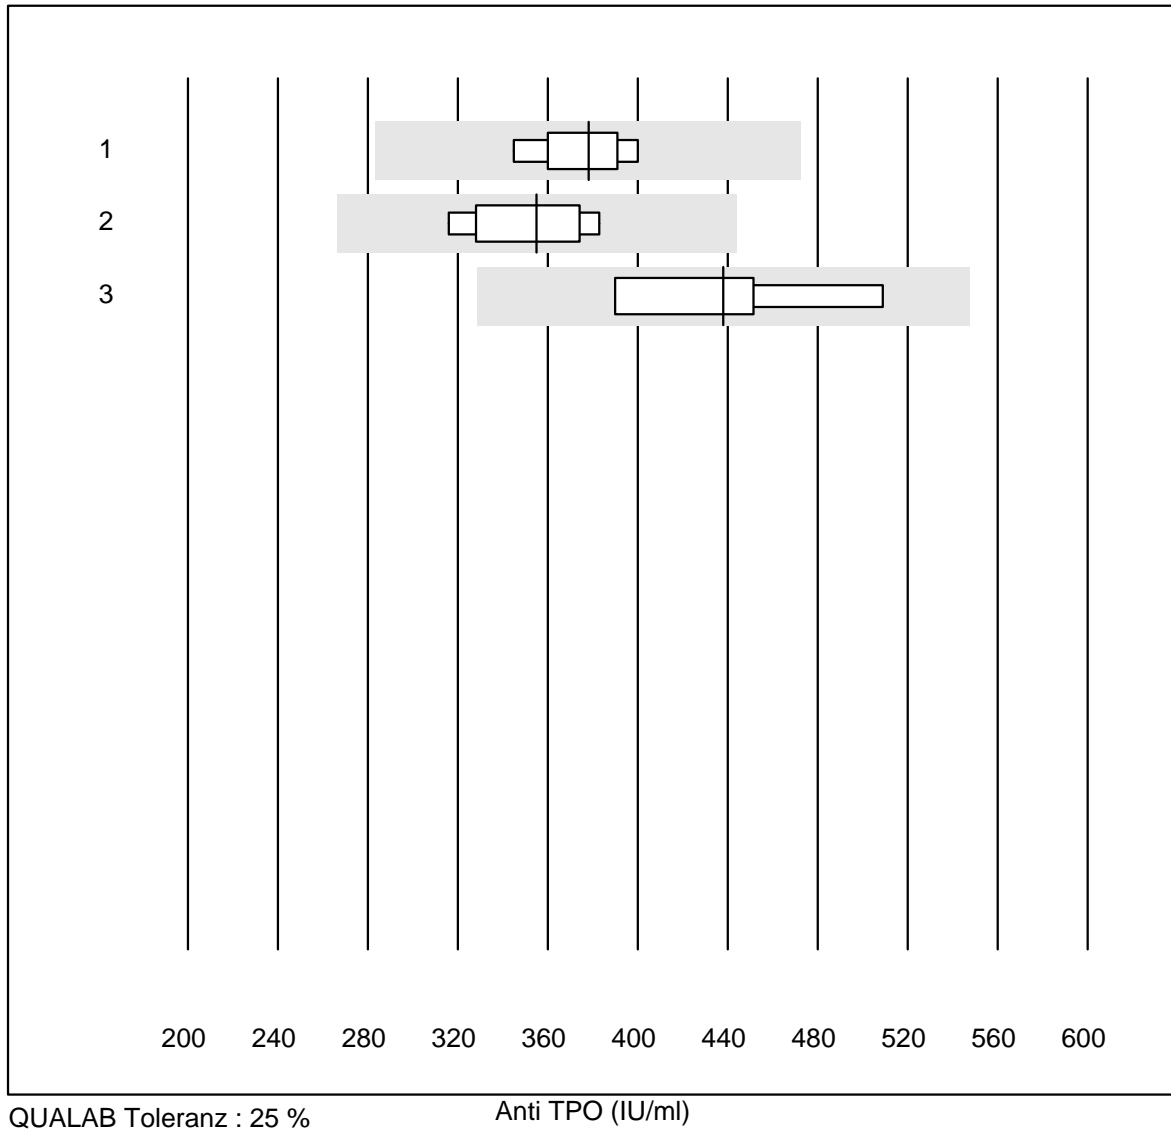


QUALAB Toleranz : 25 %

Anti TPO (IU/ml)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Phadia	5	100.0	0.0	0.0	378	6.0	e
2 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	355	8.2	e*
3 Architect	4	100.0	0.0	0.0	438	10.9	a

TRAK

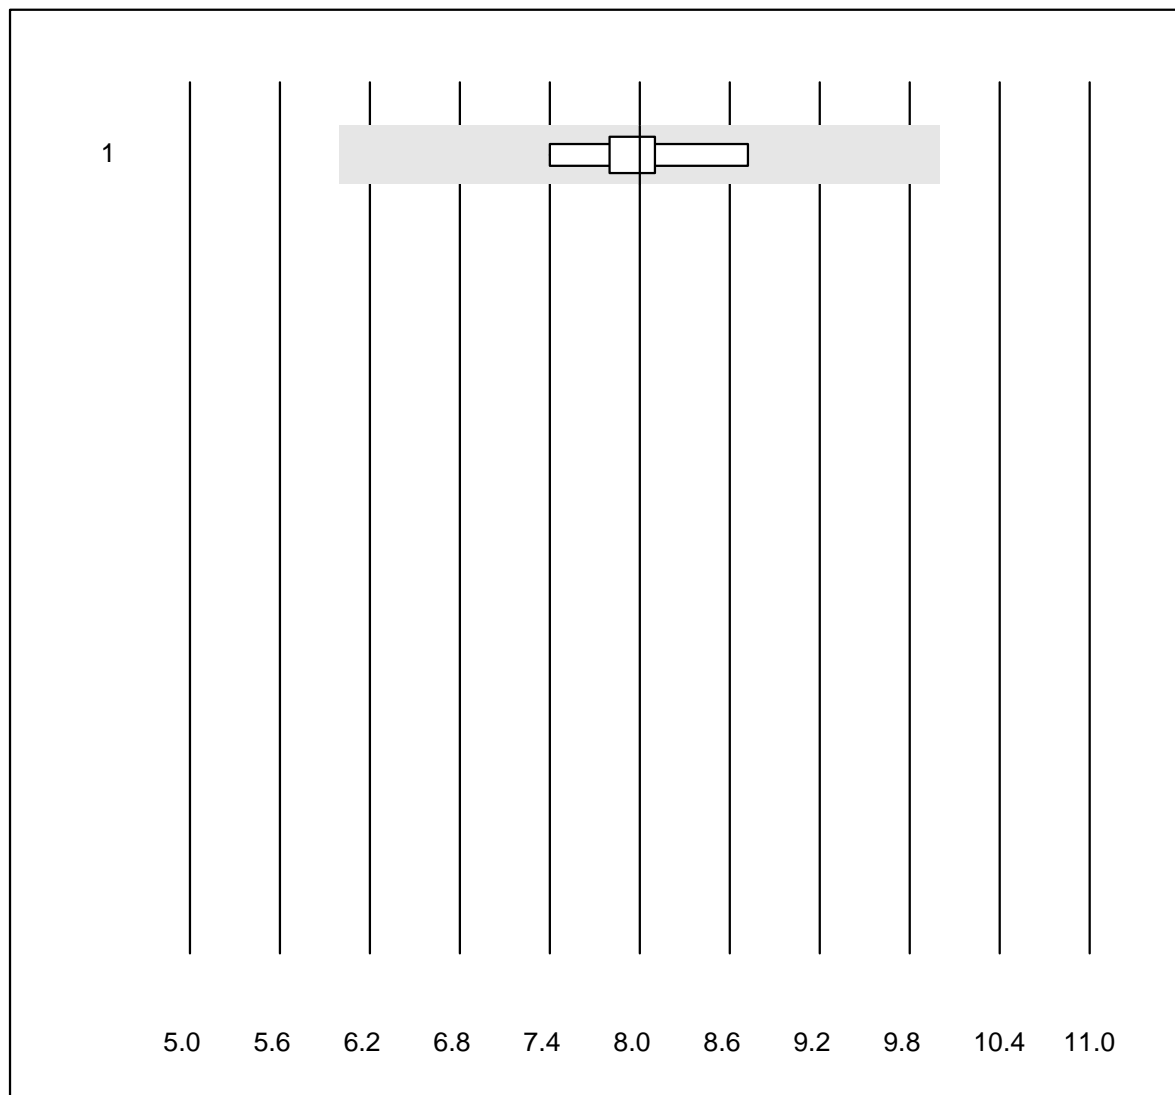


Tolérance MQ : 25 %

TRAK (IU/l)


Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Kryptor	5	100.0	0.0	0.0	8.00	6.0	e

Créatinine WB

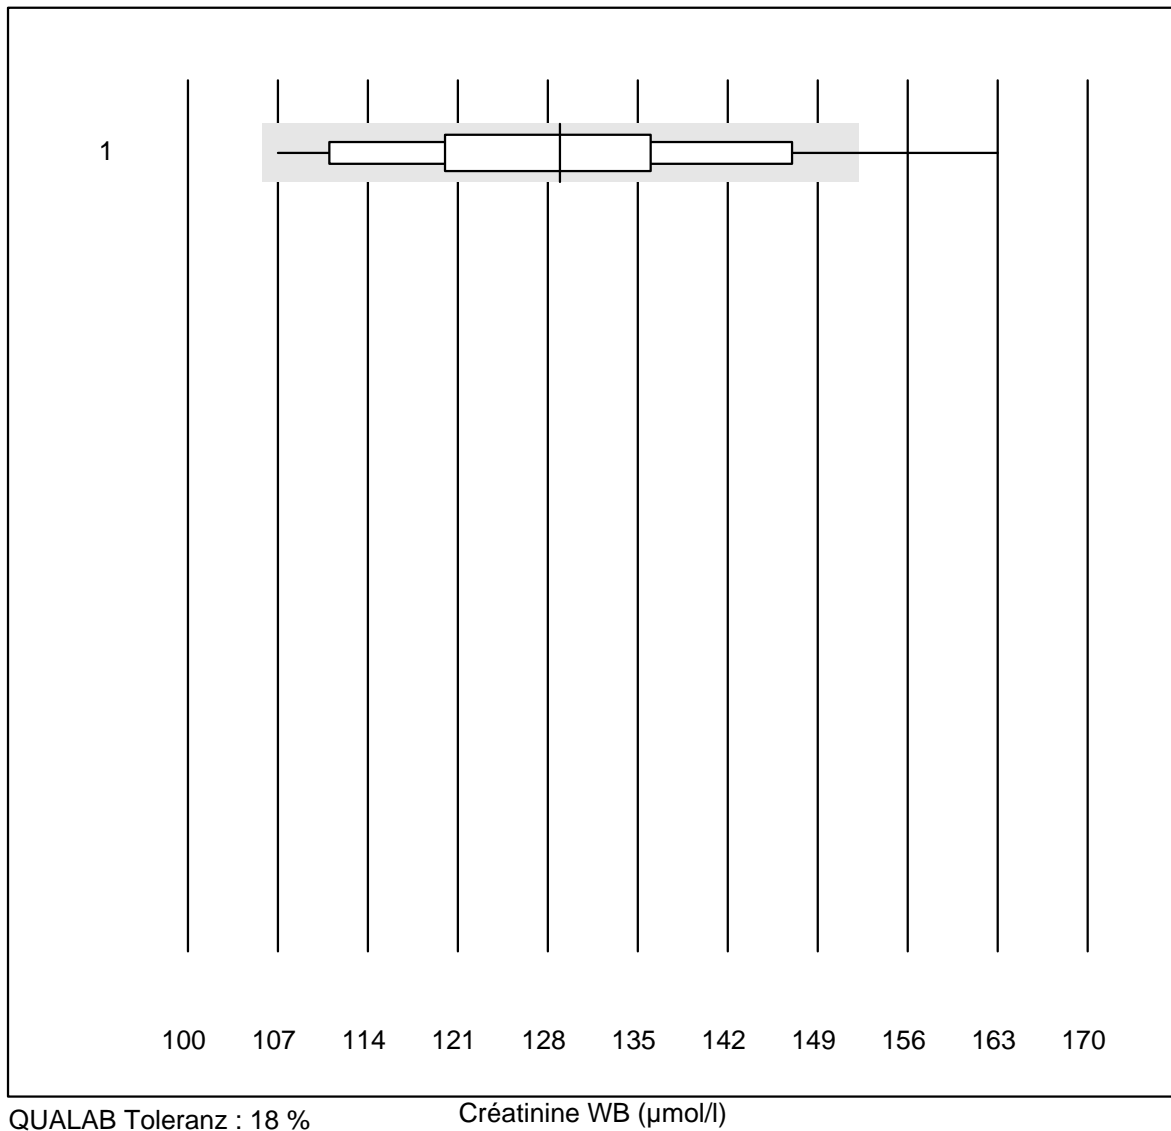

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Statsensor i / Nova	47	89.4	8.5	2.1	129	10.6	e

IL6

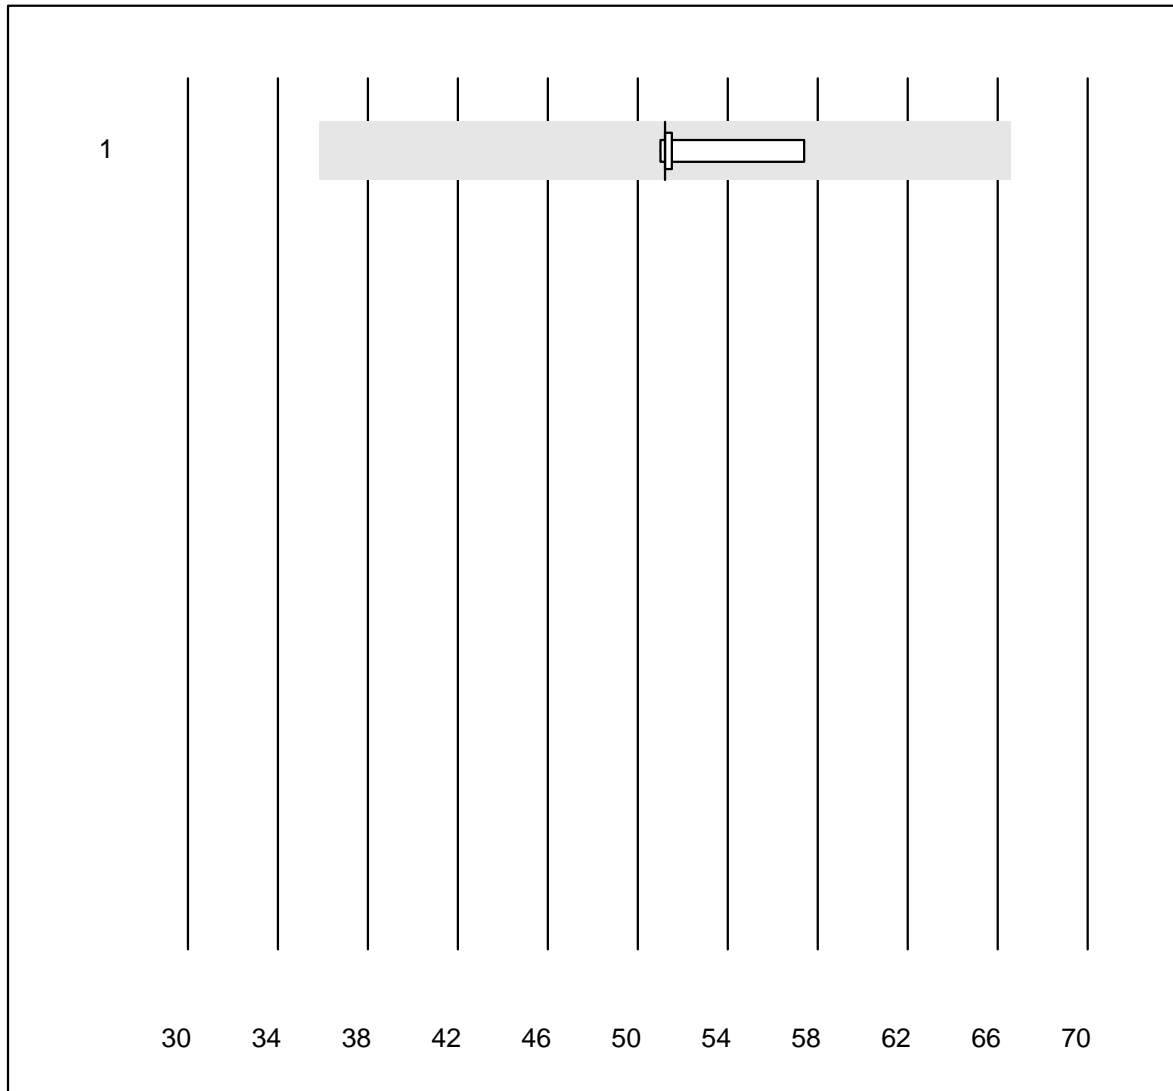


Tolérance MQ : 30 %

IL6 (ng/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	51.2	5.3	e

Amylase-urine

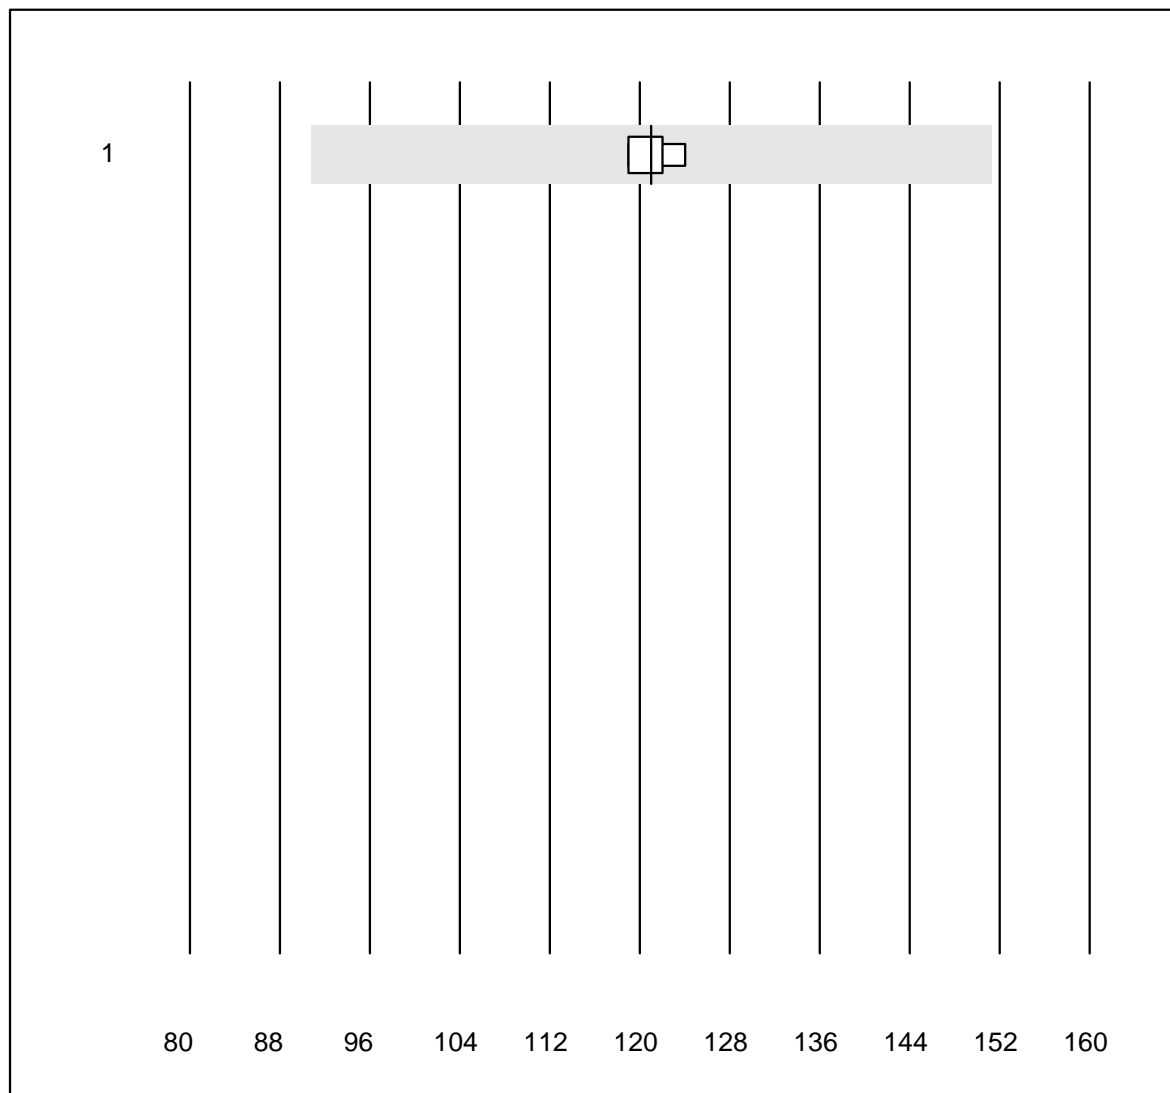


Tolérance MQ : 25 %

Amylase-urine (U/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 IFCC	4	100.0	0.0	0.0	121	1.8	e

Calcium-urine

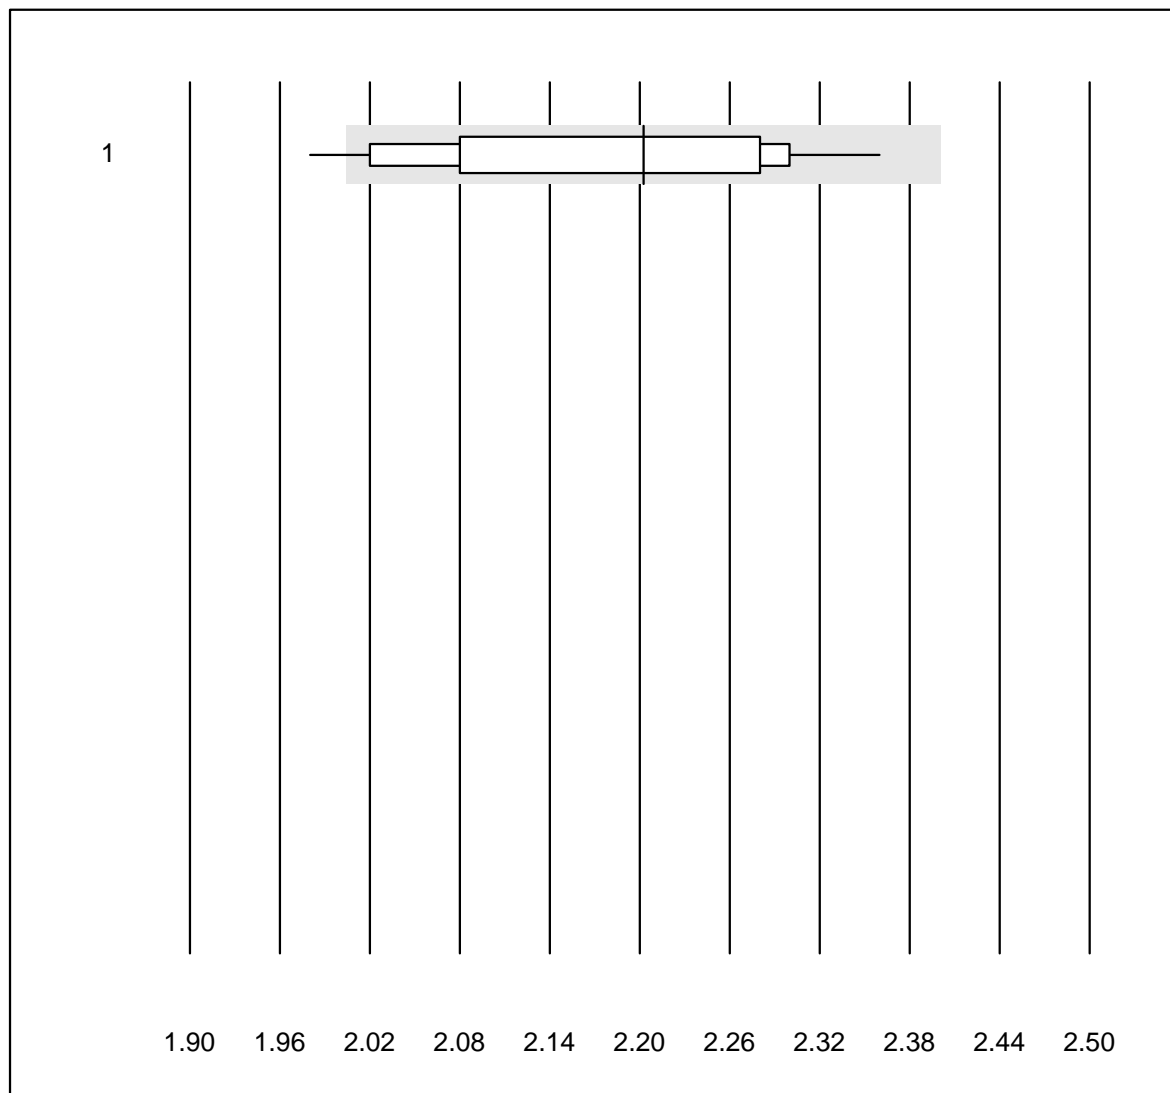


Tolérance MQ : 9 %

Calcium-urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	20	95.0	5.0	0.0	2.20	4.9	e*

Chlorures-urine

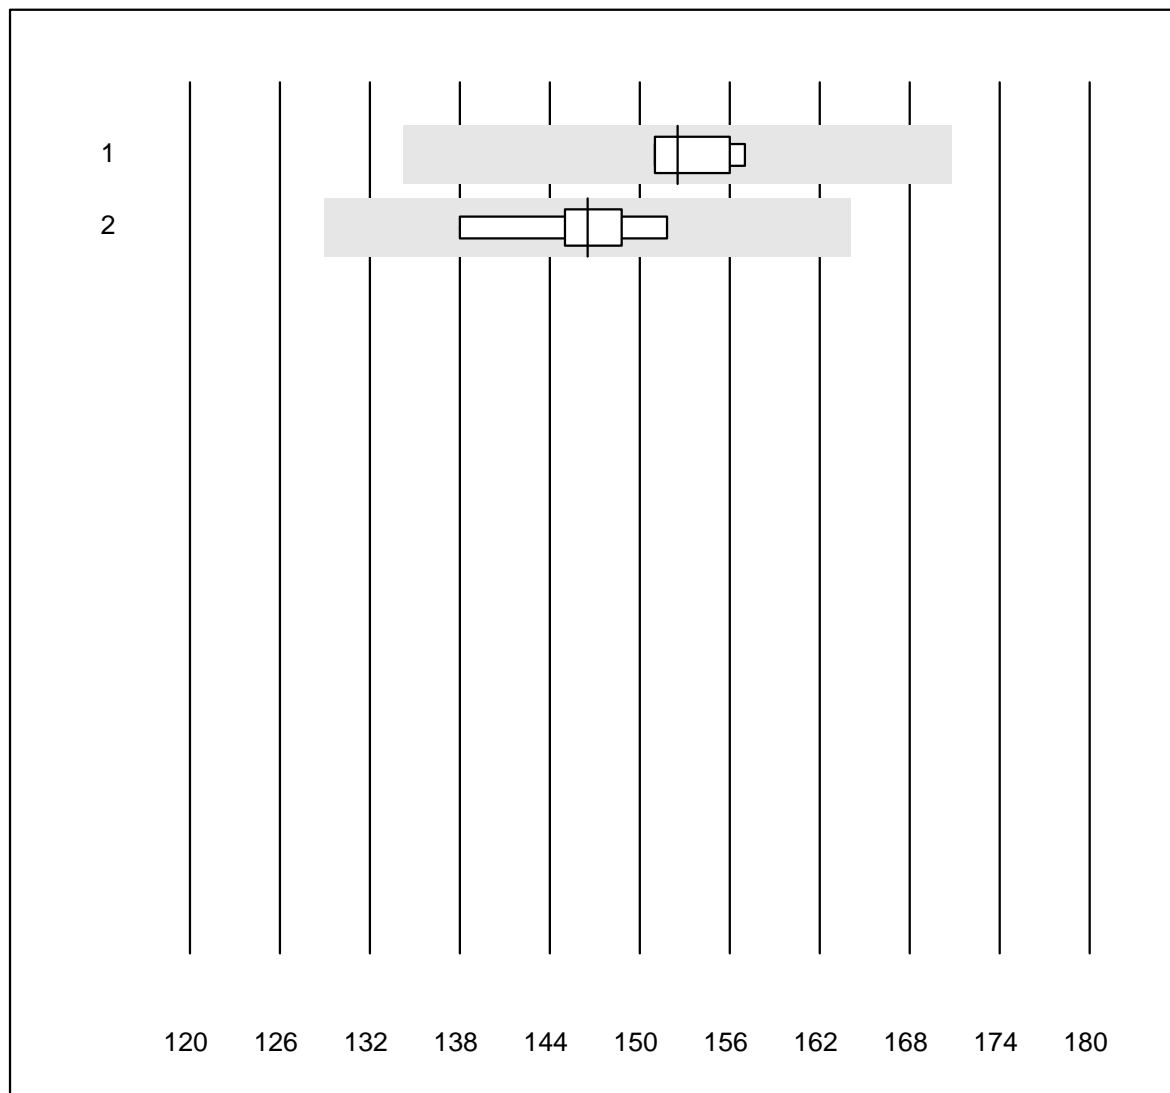


Tolérance MQ : 12 %

Chlorures-urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	6	100.0	0.0	0.0	153	1.7	e
2	Cobas	6	100.0	0.0	0.0	147	3.2	e

Glucose-urine

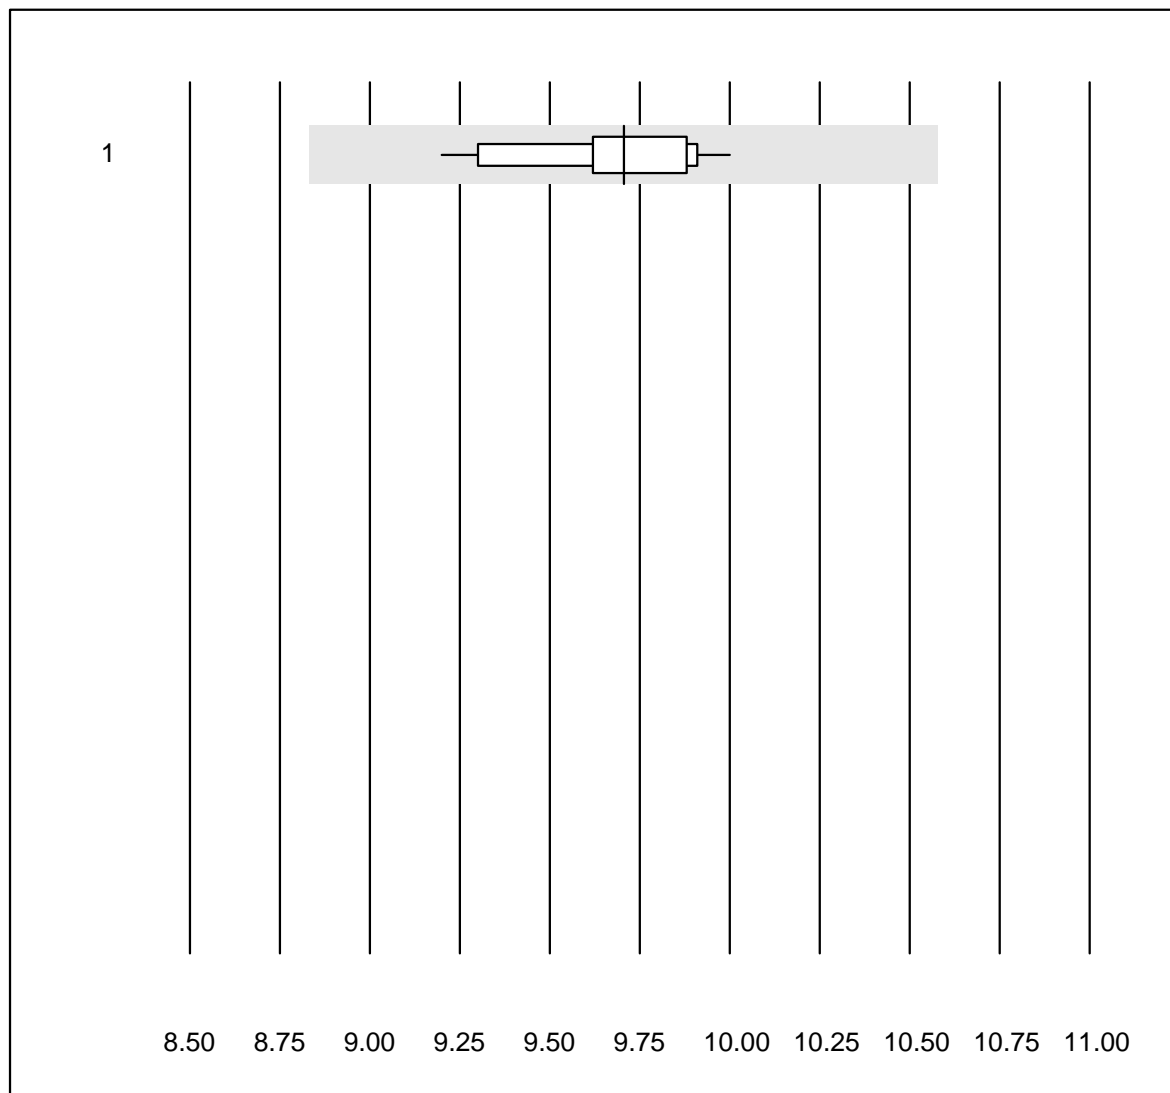


QUALAB Toleranz : 9 %

Glucose-urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	17	100.0	0.0	0.0	9.7	2.2	e

Magnésium-urine

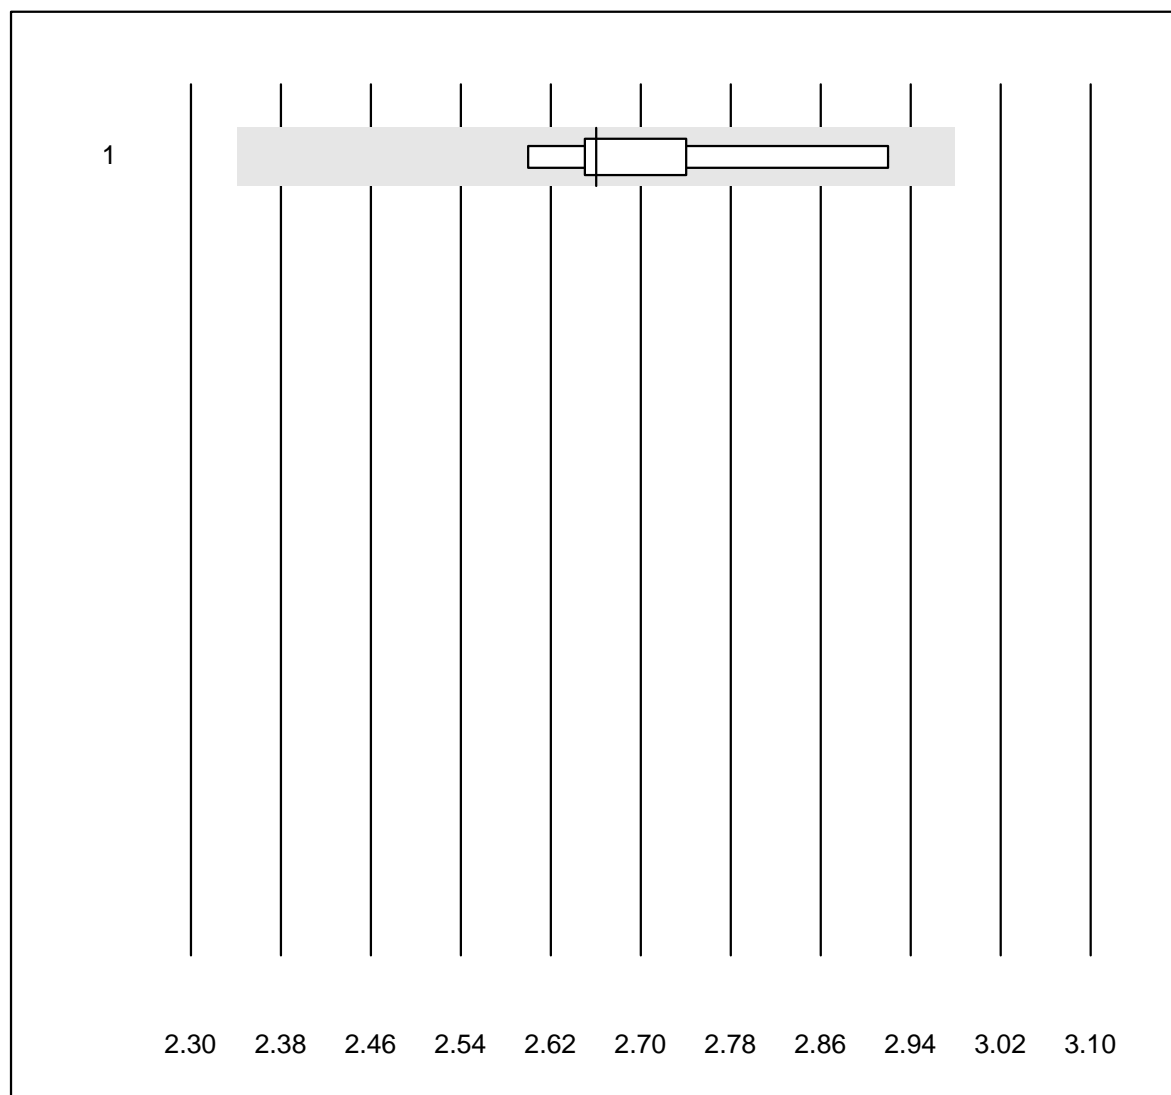


Tolérance MQ : 12 %

Magnésium-urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Efulft	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	9	100.0	0.0	0.0	2.66	3.7	e

Osmolalité-urine

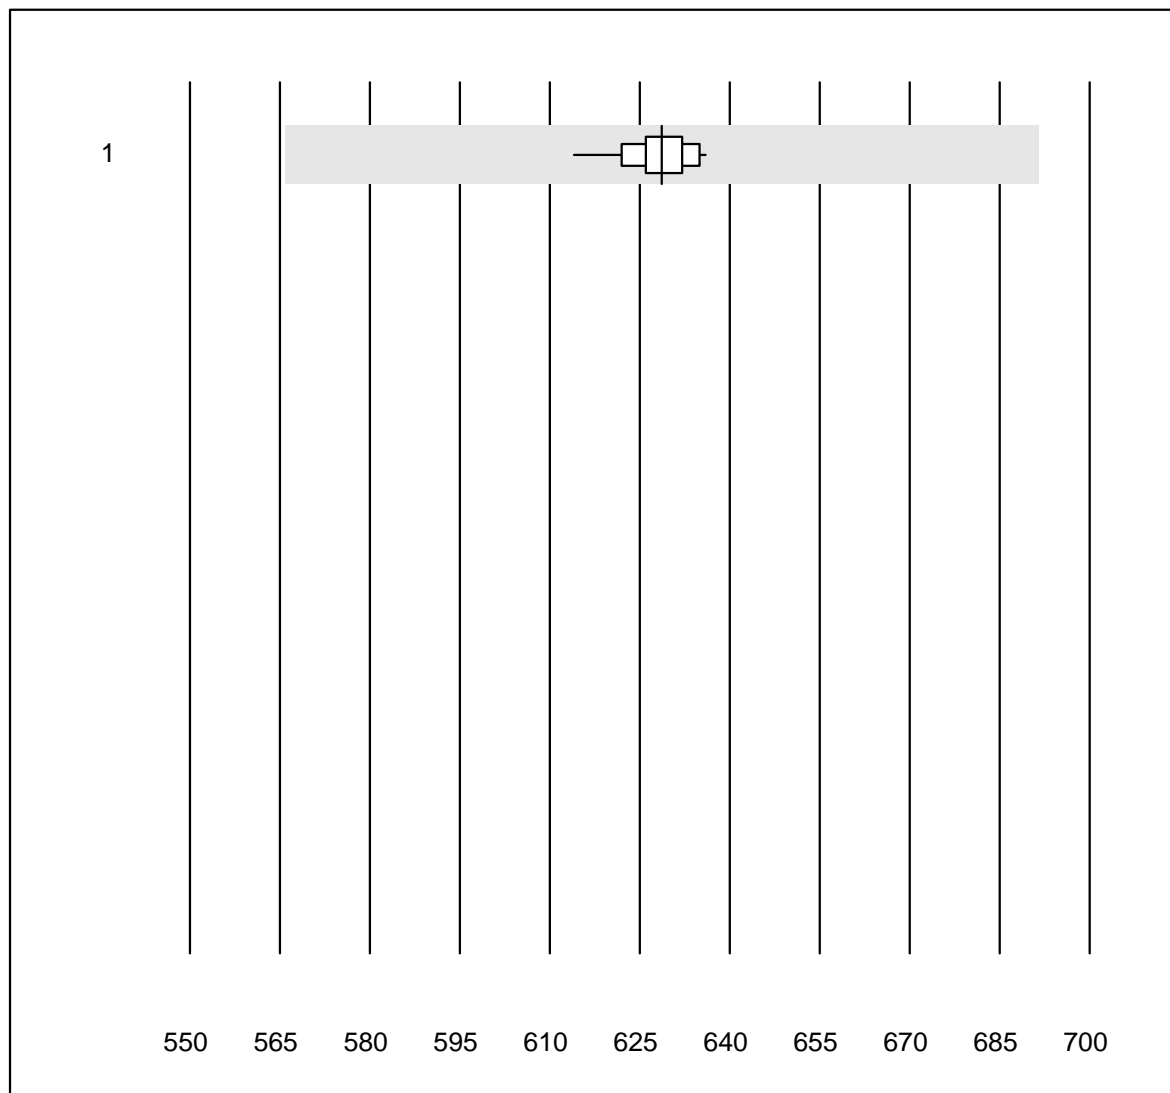


Tolérance MQ : 10 %

Osmolalité-urine (mosm/kg)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Cryoscopie	14	100.0	0.0	0.0	629	0.9	e

Phosphore-urine

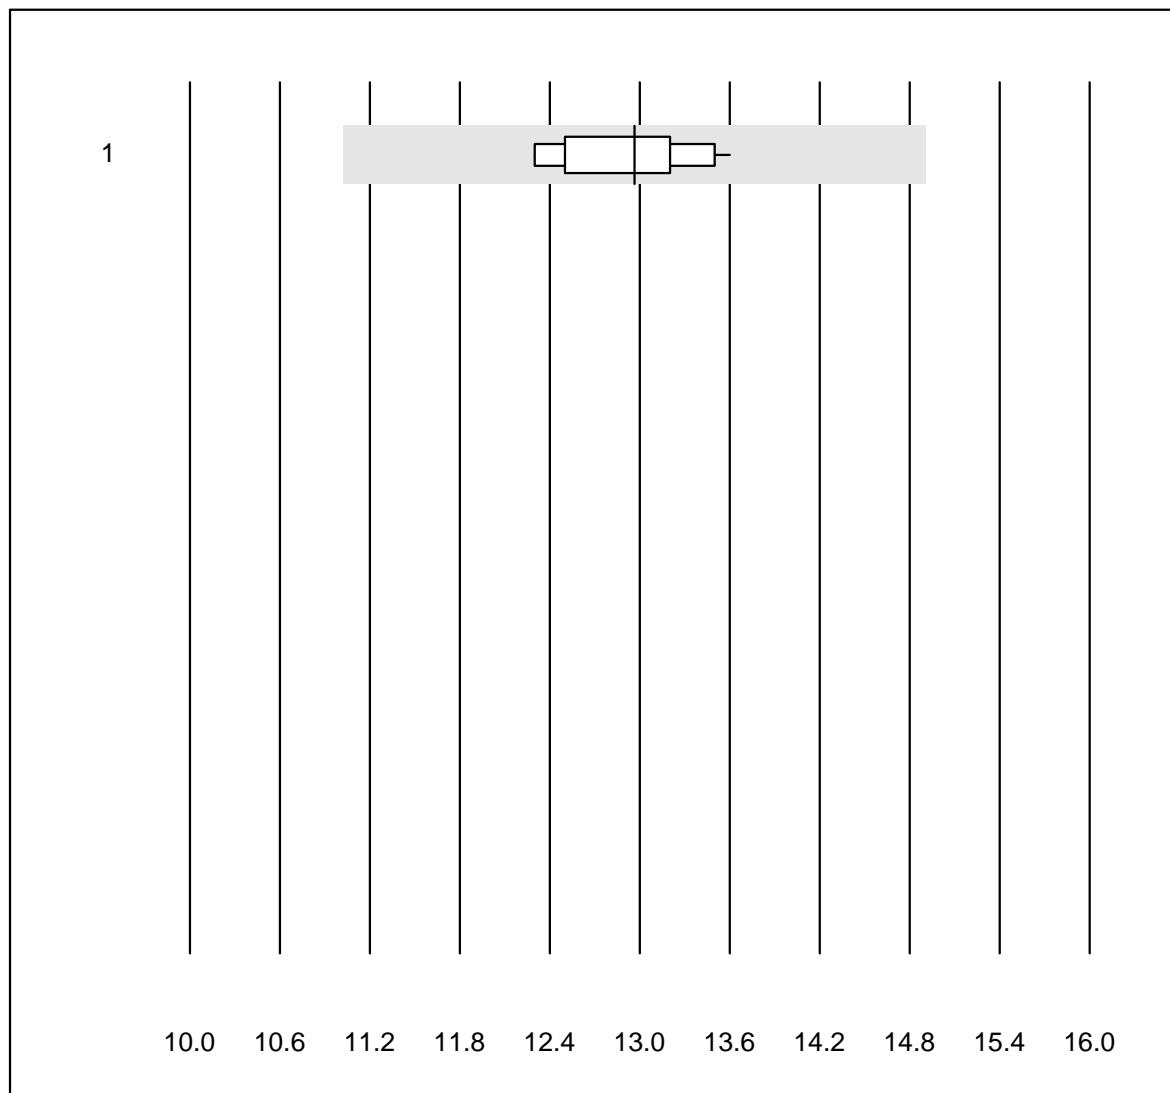


Tolérance MQ : 15 %

Phosphore-urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Efulft	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	16	100.0	0.0	0.0	13.0	3.3	e

Potassium-urine

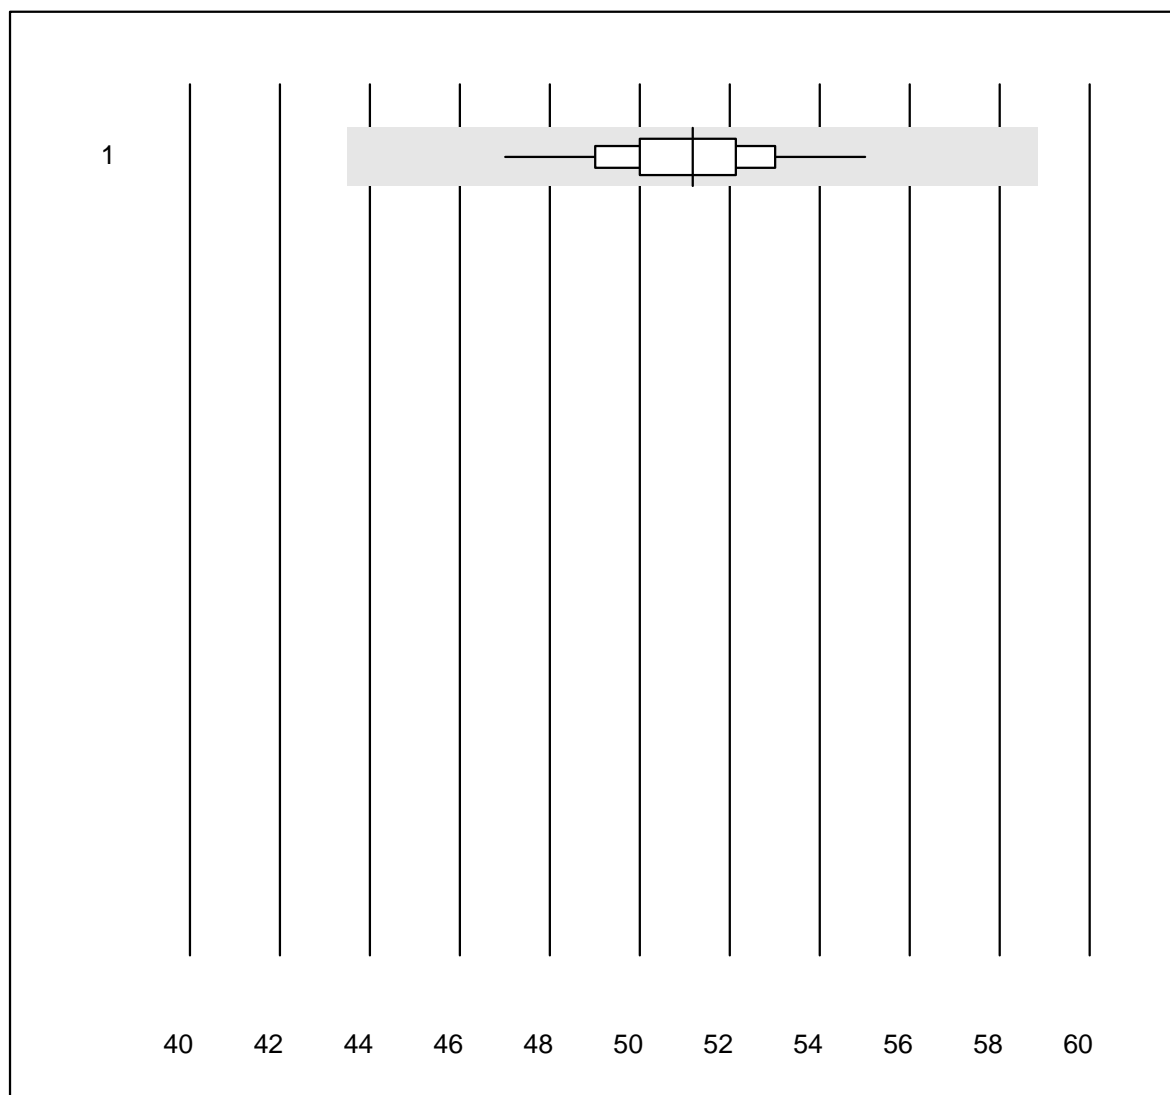

Tolérance MQ : 15 %

Potassium-urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	25	100.0	0.0	0.0	51	3.3	e

Protéines-urine




QUALAB Toleranz : 20 %

Protéines-urine (mg/l)

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Cobas/Roche	15	100.0	0.0	0.0	373.5	6.5	e
2 Chimie humide	11	100.0	0.0	0.0	461.4	3.3	e

Sodium-urine

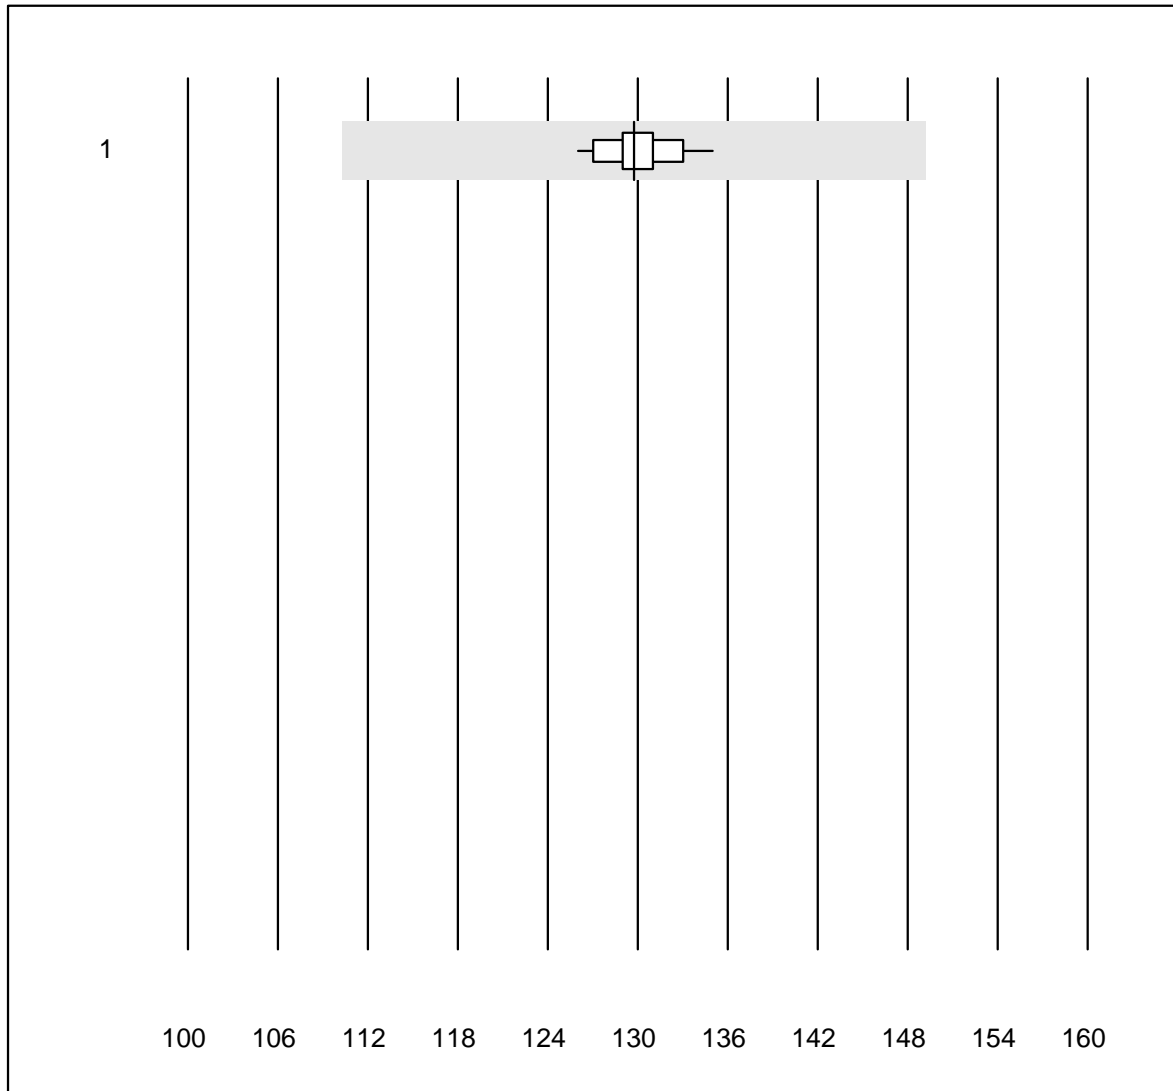


Tolérance MQ : 15 %

Sodium-urine (mmol/l)


Nr.	Methode	Total	% Efulft	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	toutes les méthodes	26	100.0	0.0	0.0	130	1.6	e

Urée-urine

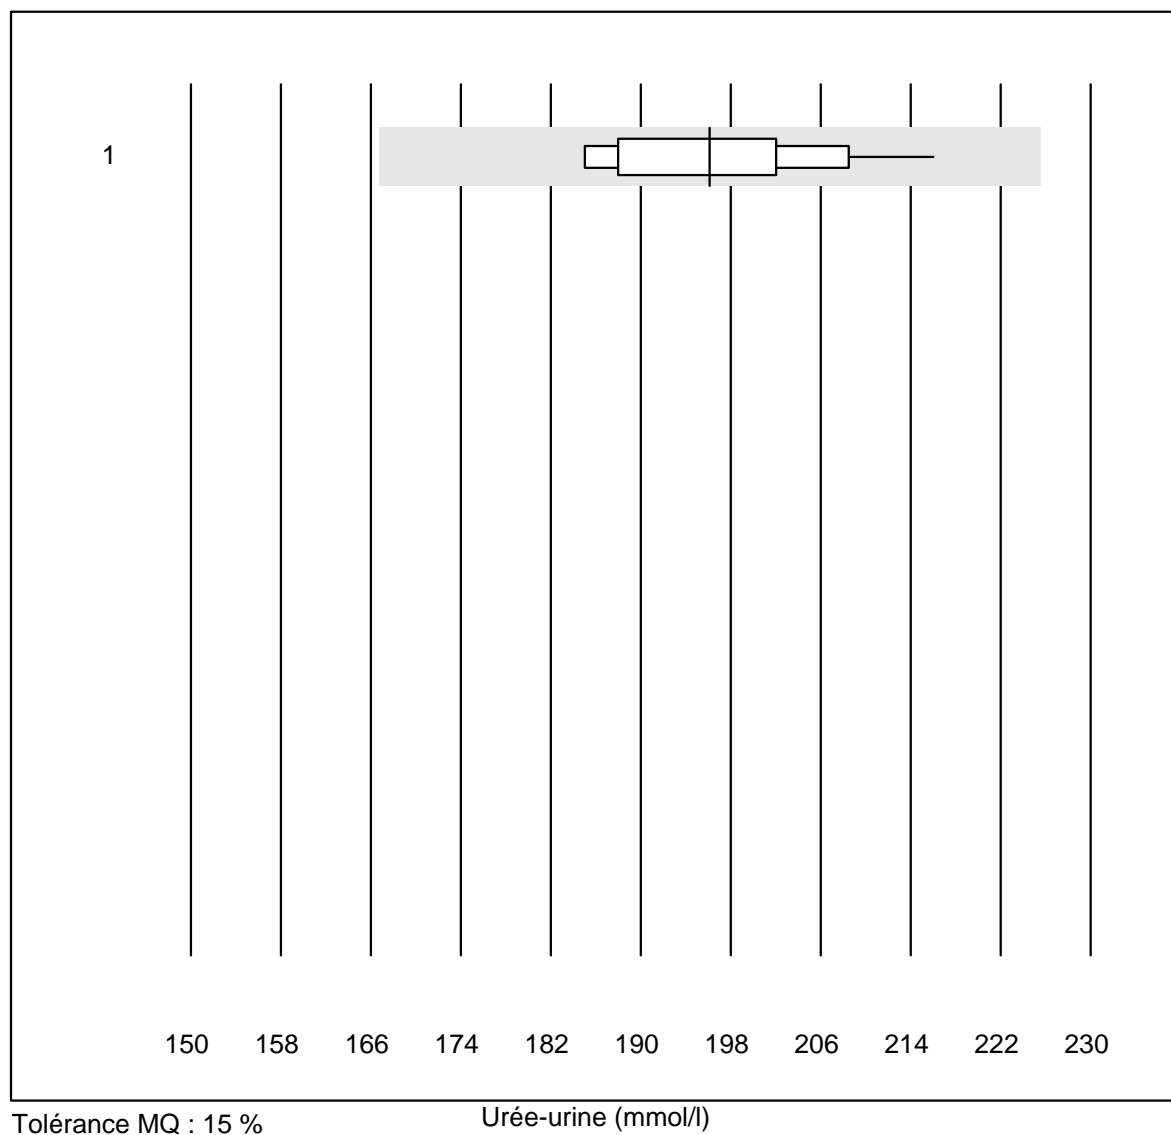

Nr. Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1 Chimie humide	22	100.0	0.0	0.0	196	4.7	e

Acide urique-urine

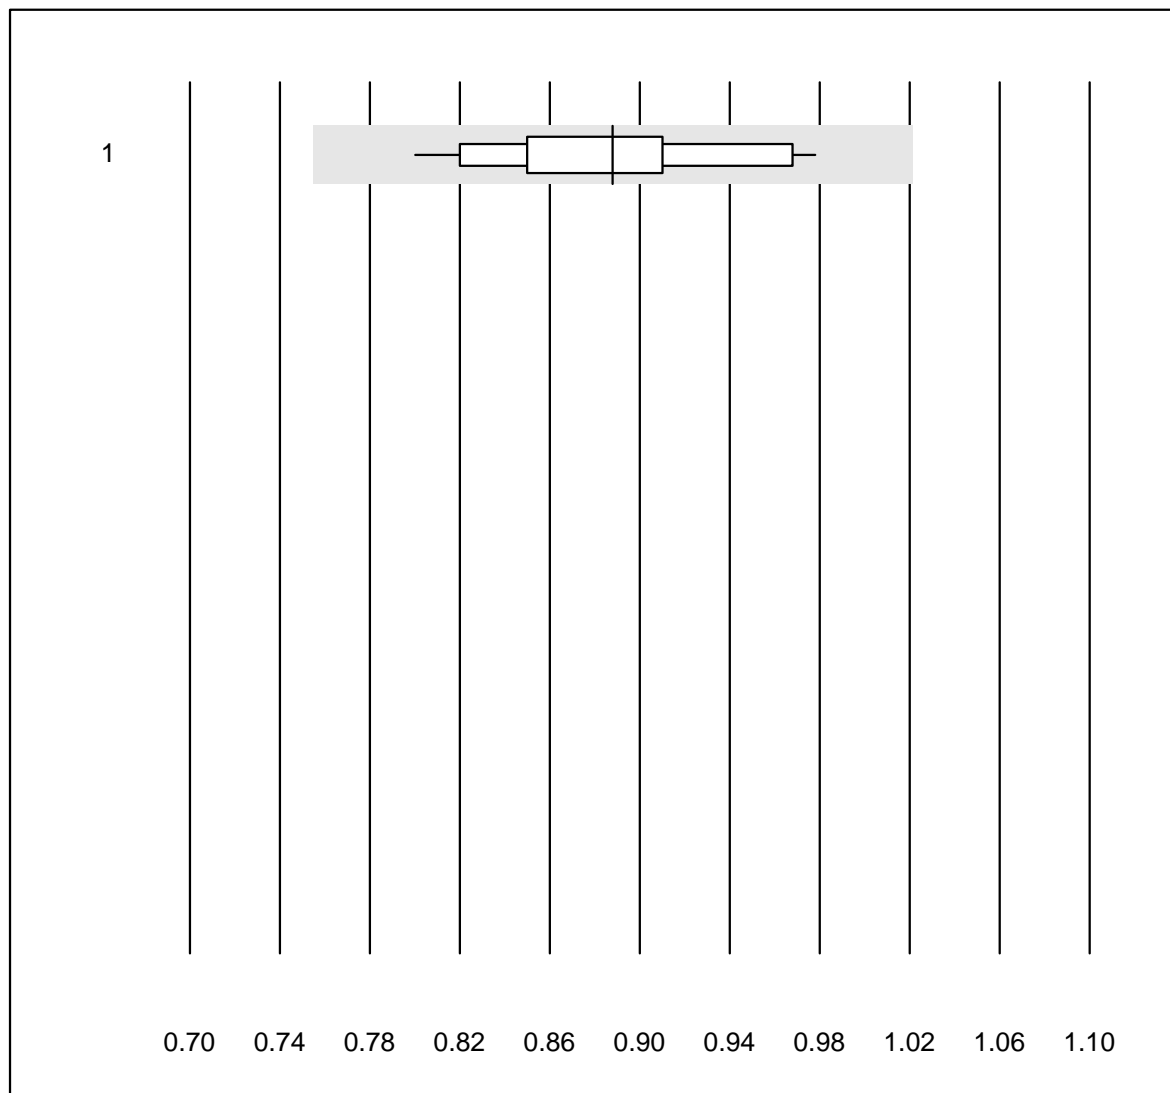


Tolérance MQ : 15 %

Acide urique-urine (mmol/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Chimie humide	16	100.0	0.0	0.0	0.89	5.8	e

Gravité spécifique-urine

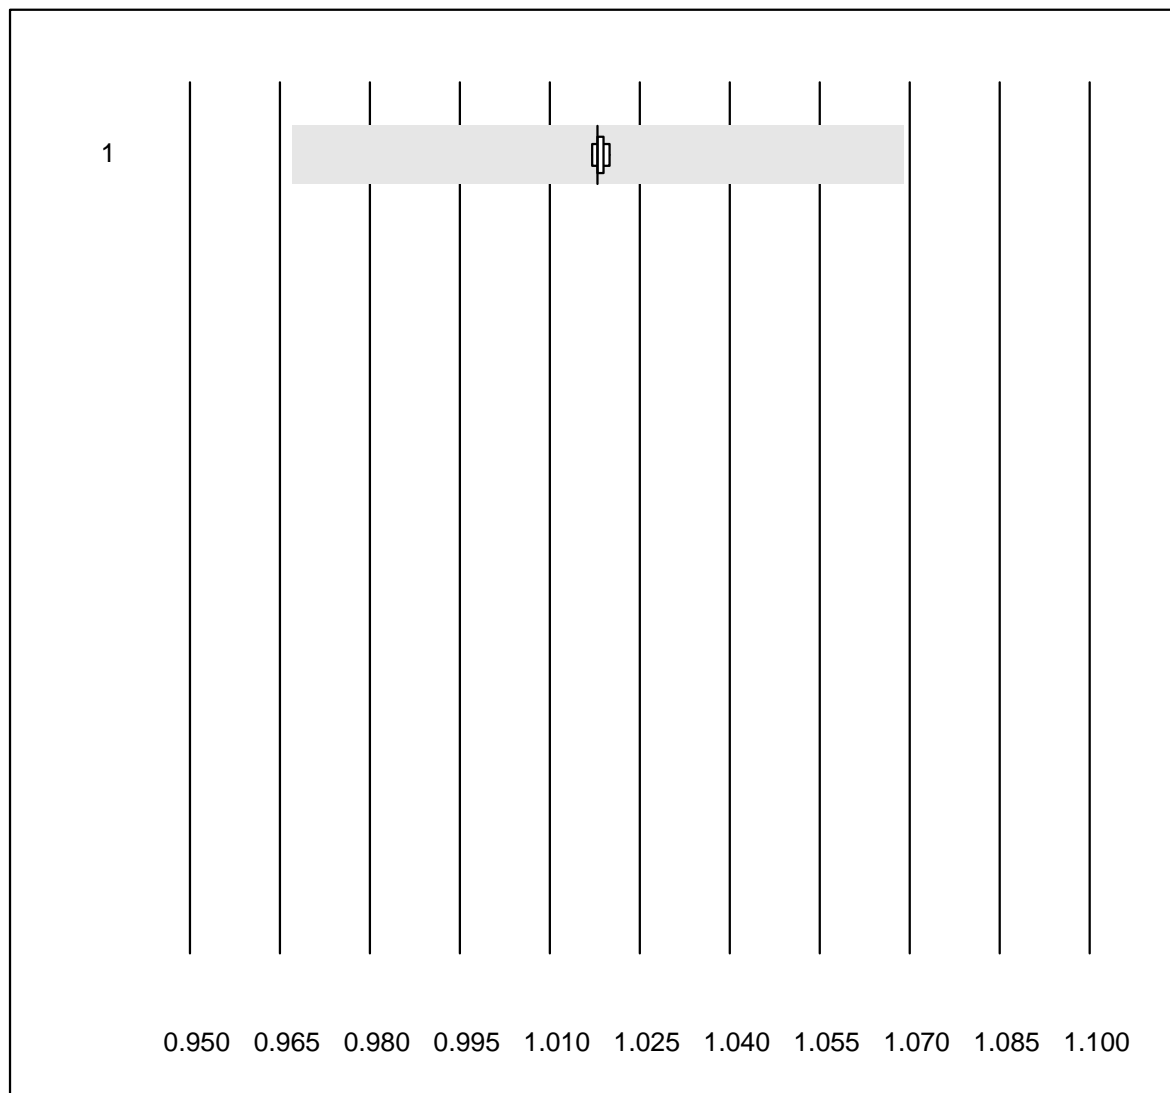


Tolérance MQ : 5 %

Gravité spécifique-urine ()

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Refraktometer	5	100.0	0.0	0.0	1.018	0.1	e

Microalbumine

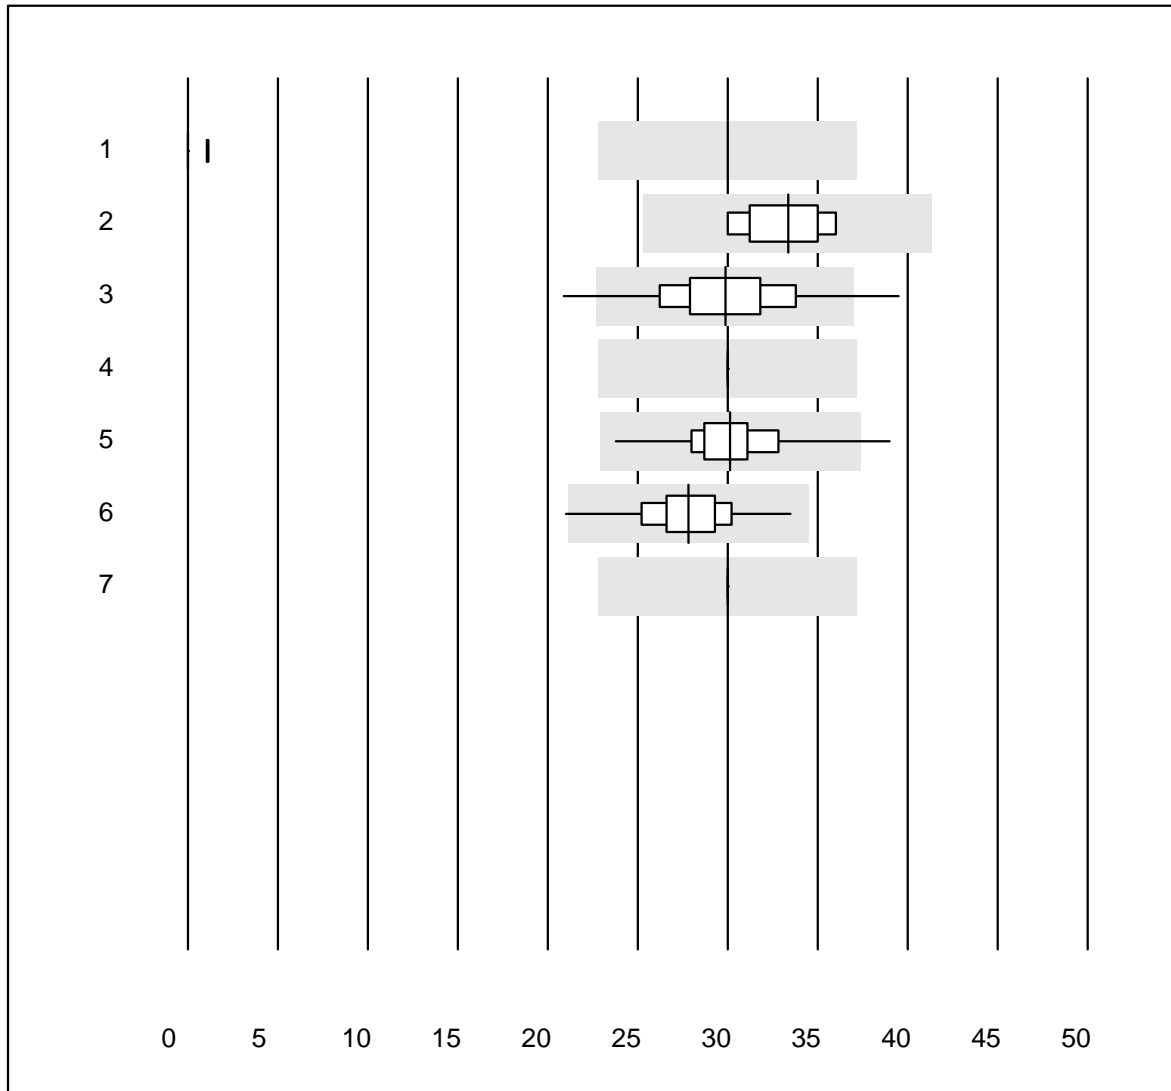


QUALAB Toleranz : 24 %

Microalbumine (mg/l)

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	Aution	4	0.0	0.0	100.0	30.0	0.0	a
2	AFIAS	10	100.0	0.0	0.0	33.4	6.8	e
3	Afinion	451	95.1	2.9	2.0	29.9	10.2	e
4	Sysmex U	17	52.9	0.0	47.1	30.0	0.0	a
5	Turbidimetrie	26	92.3	7.7	0.0	30.1	10.5	e
6	DCA2000/Vantage	146	95.2	0.7	4.1	27.8	7.8	e
7	Siemens Clinitek	12	41.7	0.0	58.3	30.0	0.0	a

Créatinine urine

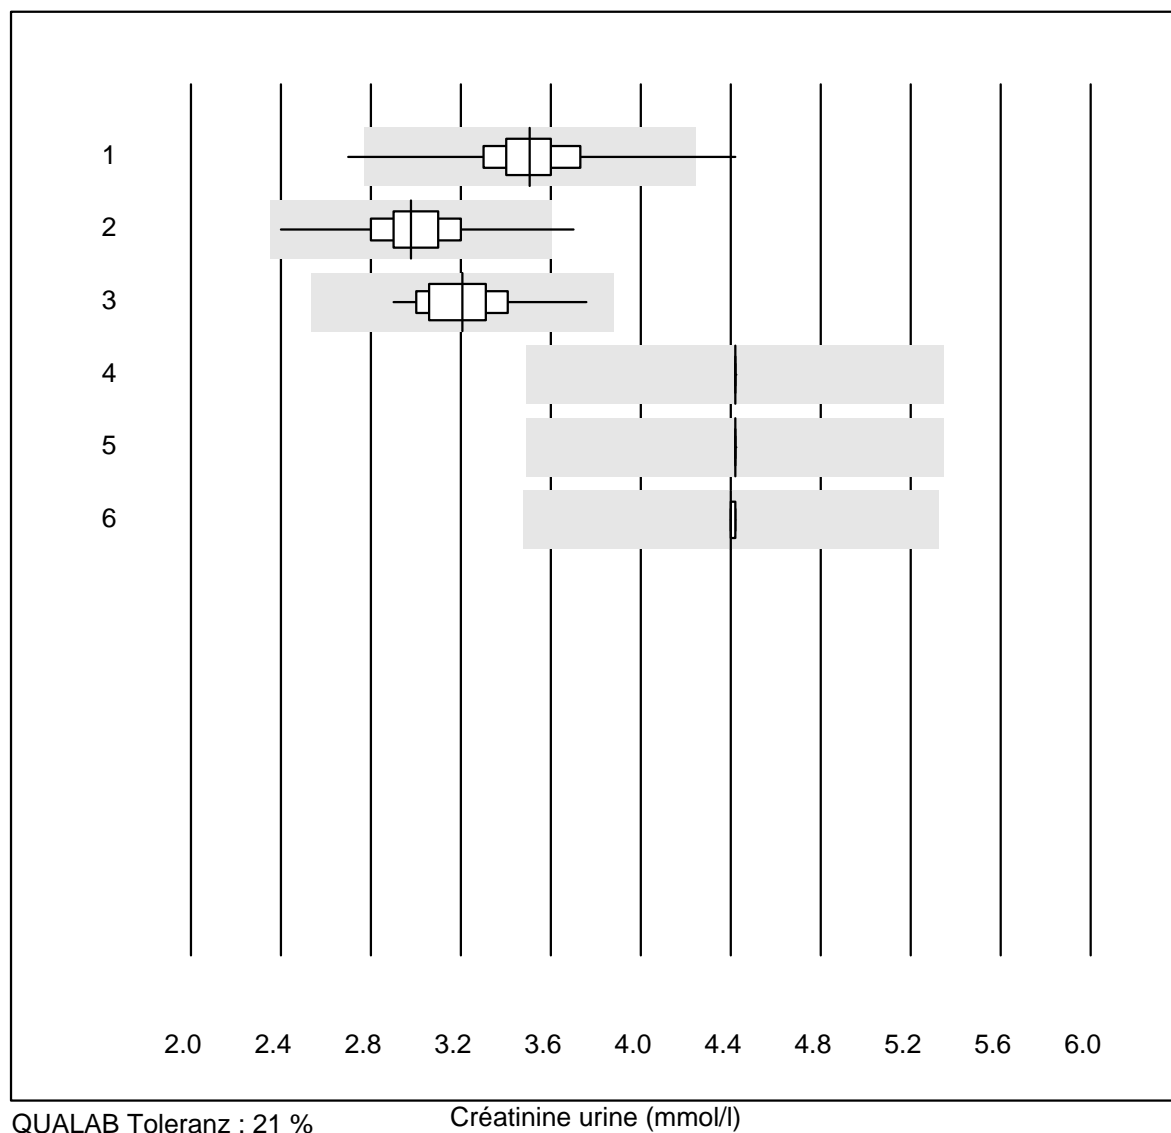

Nr.	Methode	Total	% Erfüllt	% ungen.	% Ausr	Zielwert	VK%	Typ
1	DCA2000/Vantage	146	93.1	1.4	5.5	3.5	5.8	e
2	Afinion	451	97.8	0.4	1.8	3.0	5.3	e
3	Chimie humide	40	100.0	0.0	0.0	3.2	5.8	e
4	Sysmex U	15	80.0	0.0	20.0	4.4	0.0	e
5	Aution	4	75.0	0.0	25.0	4.4	0.0	e
6	Siemens Clinitek	12	91.7	0.0	8.3	4.4	0.2	a