

Verein für
Association pour le
Associazione per il



medizinische Qualitätskontrolle
contrôle de qualité médical
controllo di qualità medico

Commentaire de l'essai interlaboratoire

2021 - 2

Échantillons de l'essai interlaboratoire

L'homogénéité et la stabilité ont été vérifiées pour tous les échantillons avant respectivement pendant l'envoi et aucune anomalie n'a été constatée. Les tests de conformité ont été réalisés par les laboratoires de l'Hôpital Universitaire de Zürich (<http://www.uzl.usz.ch/>).

Ont été produits spécifiquement pour MQ en sous-traitance les échantillons d'essai interlaboratoire suivants:

B1 Strep A Test, B2 Uricult, H4 Hématologie parasitaire, K14 Marqueur tumoral

Détermination des valeurs-cible

Pour chaque valeur-cible est indiqué le mode de détermination utilisé selon les termes de la norme ISO17043:2010, B2.1 (Colonne "Type"):

- Valeur connue, sur la base de la production.
- Valeur de référence certifiée lors de l'utilisation d'échantillons spécifiques
- Valeur de référence déterminée par analyse
- „Consensus value“ des laboratoires d'experts
- „Consensus value“ des participants

Pour les groupes de méthode incluant plus de 9 participants, les valeurs cibles sont déterminées comme étant la „Consensus value“ ("e") des participants. Pour la détermination de ces valeurs cibles est utilisée la moyenne réalisée par le groupe de méthodes. Les résultats qui présentent un écart par rapport à la valeur cible supérieur à 1.5 fois la tolérance Qualab, sont considérés comme résultats aberrants et exclus du calcul de la valeur de référence. Les résultats des essais d'aptitude sont utilisés comme valeur de base pour éliminer les taux aberrants. Afin de mettre à disposition de tous les participants des valeurs-cible les plus pertinentes possibles, d'autres procédures peuvent également être utilisées pour des groupes de méthode plus restreints.

Incertitude dans la détermination des valeurs-cible

L'incertitude-type (u_x) est calculée à l'aide de la formule suivante (ISO13528):

$$u_x = (\text{Valeur-cible}/100) * (1.25/\text{Racine carrée du "nombre des participants"}) * \text{CV en \%}$$

- u_x est exprimée dans la même unité que la valeur-cible
- u_x peut être comparée avec l'écart-type du collectif des participants ($\text{Ecart-type} = \text{Valeur-cible} * \text{CV en \%} / 100$)
- Pour un nombre de participants >18 , l'incertitude-type (u_x) est significativement plus petite que la dispersion du collectif des participants et peut donc être négligée.


Tolérances QUALAB et MQ

Pour les analyses obligatoires sont utilisées les tolérances fixées par Qualab (www.qualab.ch, contrôle de qualité externe). Pour les analyses non-obligatoires, les tolérances sont fixées par le directeur de MQ pilotant l'essai interlaboratoire.

Si l'incertitude déterminée de la valeur de référence u_x est supérieure à 15% de la tolérance QUALAB ou de MQ, la lettre qui caractérise le type de détermination de la valeur-cible est en outre marquée d'une étoile (par exemple "e*"). Nous rendons ainsi les participants attentifs au fait que l'incertitude de la valeur de référence peut avoir une influence sur l'évaluation.

Représentation graphique

La représentation graphique des résultats est la suivante:

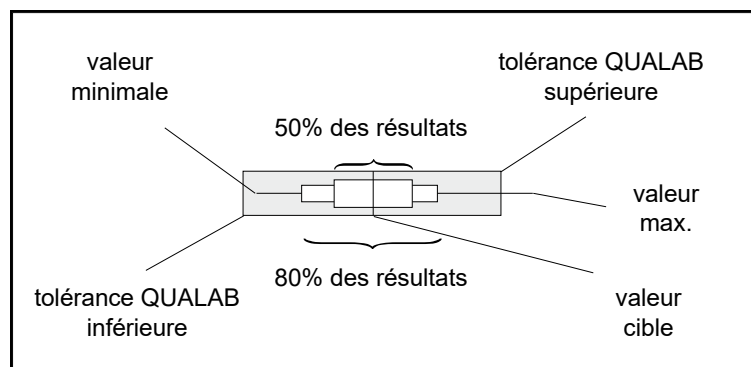

Comparaison des appareils

Les données de ce rapport vous permettent de comparer les performances respectives des divers appareils. Toutefois, vous devez tenir compte des points suivants:

- Le contrôle Chimie K1 est un sérum de contrôle commercialisé prêt à l'emploi. Même si l'échantillon est d'origine humaine, des effets matriciels sont possibles. Ceux-ci dépendent de l'appareil et peuvent générer des valeurs cible différentes.
- Seul un échantillon a été mesuré. La dispersion des résultats étant dépendante de la nature de l'échantillon (effets matriciels) et du niveau du résultat, les coefficients de variation déterminés (CV en %) ne sont pas toujours valables.
- Une grande partie des taux aberrants est due à des erreurs administratives (erreur d'unité, confusion des résultats) ou à des erreurs de manipulation (erreur d'échantillon, dissolution incorrecte, mélange insuffisant) et n'a rien à voir avec le type d'appareil.


Zürich, 5.7.2021



Dr. R. Fried
Directeur de l'essai interlaboratoire

Il n'est pas autorisé de publier une partie ou l'intégralité de ce rapport sans notre accord écrit préalable. L'original est conservé dans les archives sous www.mqzh.ch.

Quick OA

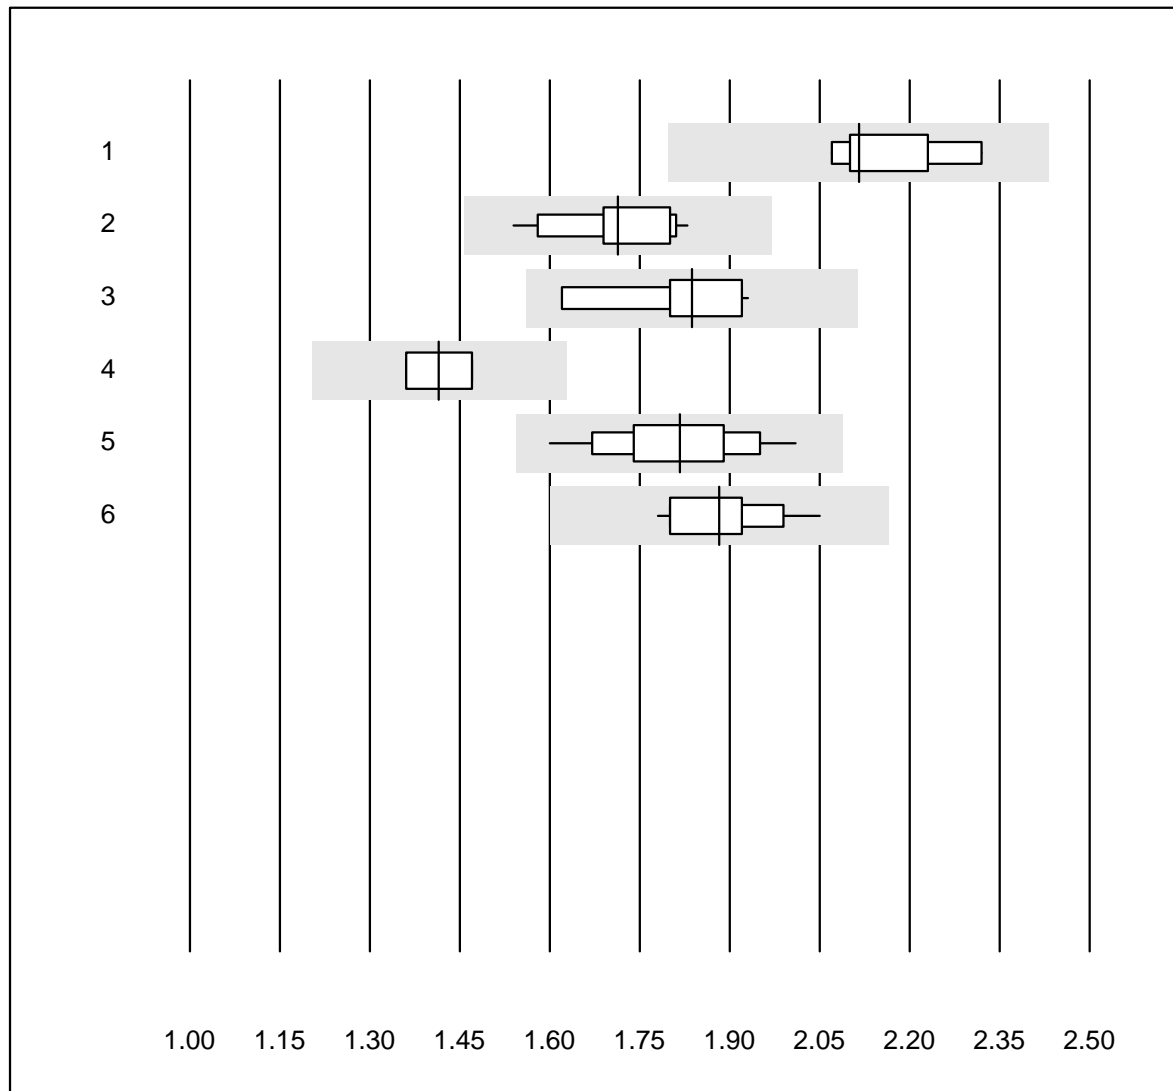


QUALAB Tolérance : 15 %

Quick OA ()


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Neoplastin Plus	6	100.0	0.0	0.0	2.12	4.5	e*
2 Innovin	14	100.0	0.0	0.0	1.71	4.9	e
3 Recombiplastin 2G	10	100.0	0.0	0.0	1.84	5.1	e
4 Eurolyser	4	75.0	0.0	25.0	1.42	4.5	e*
5 Autres méthodes	13	92.3	0.0	7.7	1.82	6.4	e
6 Neoplastin R	12	100.0	0.0	0.0	1.88	4.6	e

Fibrinogène OA

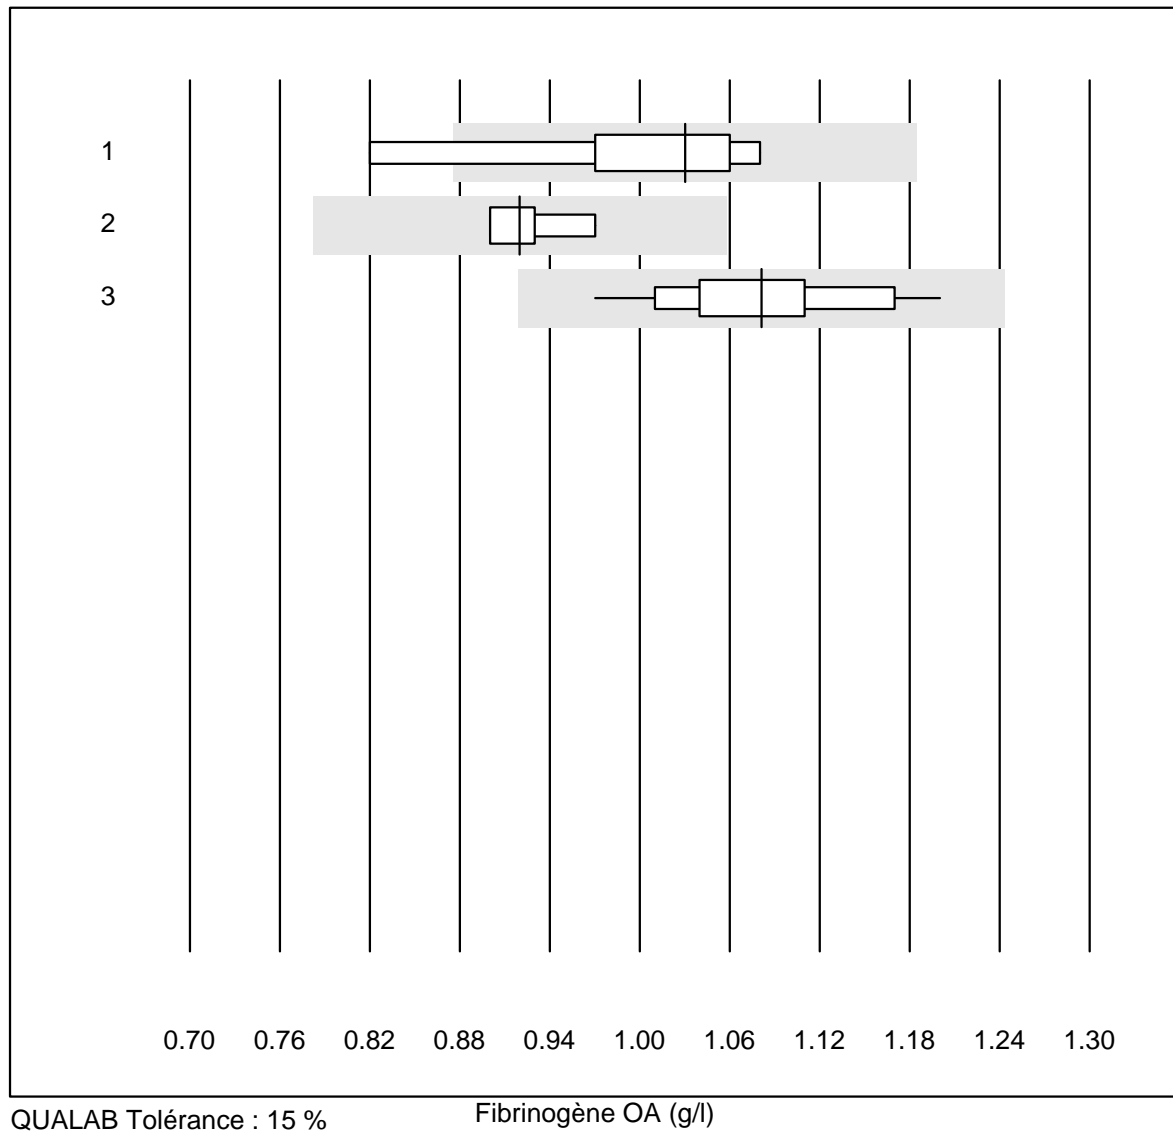

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Autres méthodes	8	87.5	12.5	0.0	1.03	8.4	e*
2 Siemens Thrombin	4	100.0	0.0	0.0	0.92	3.3	e
3 Stago/STA	16	100.0	0.0	0.0	1.08	5.8	e

aPTT OA

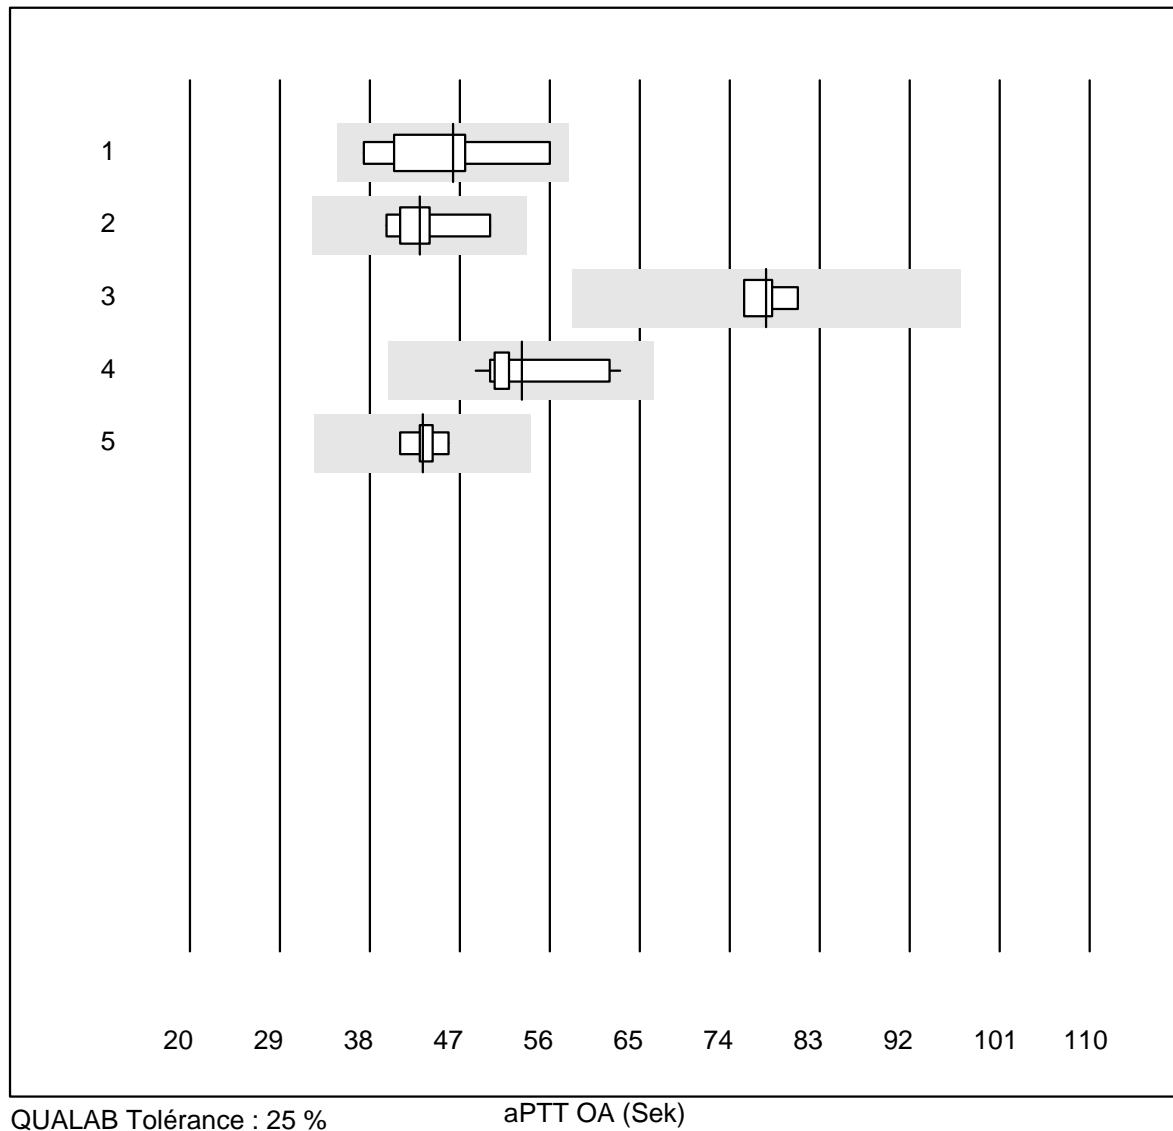


QUALAB Tolérance : 25 %

aPTT OA (Sek)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Autres méthodes	9	100.0	0.0	0.0	46.3	12.7	e*
2 Actin FS	6	100.0	0.0	0.0	43.0	8.3	e*
3 Pathromtin SL	4	100.0	0.0	0.0	77.6	2.9	e
4 Stago/STA	14	100.0	0.0	0.0	53.2	9.4	e
5 aPTT-SP	5	100.0	0.0	0.0	43.3	4.1	e

INR CoaguChek

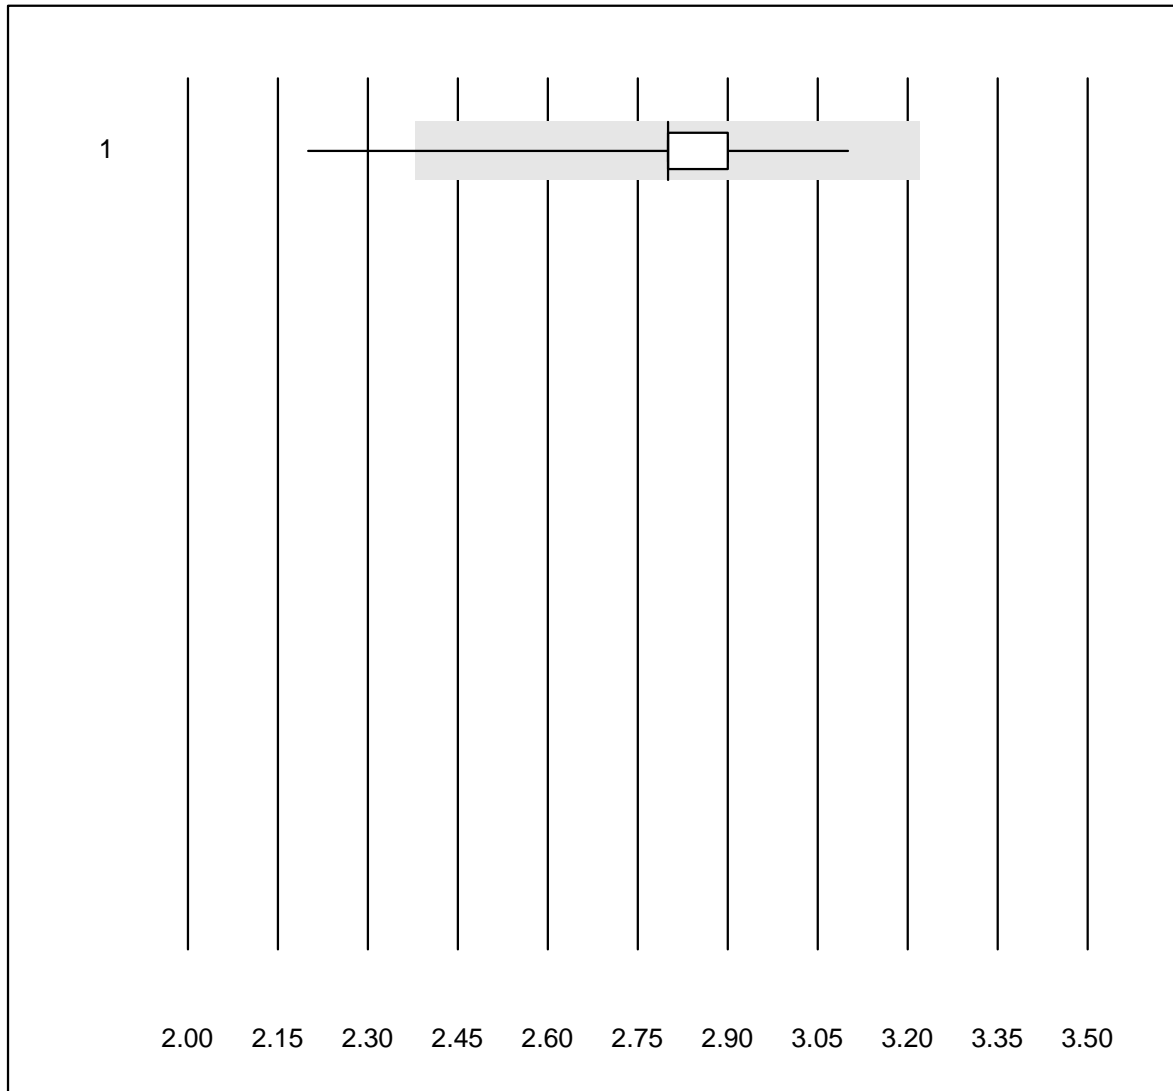


QUALAB Tolérance : 15 %

INR CoaguChek ()

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 CoaguChek Pro II	663	99.2	0.3	0.5	2.8	3.3	e

Quick N

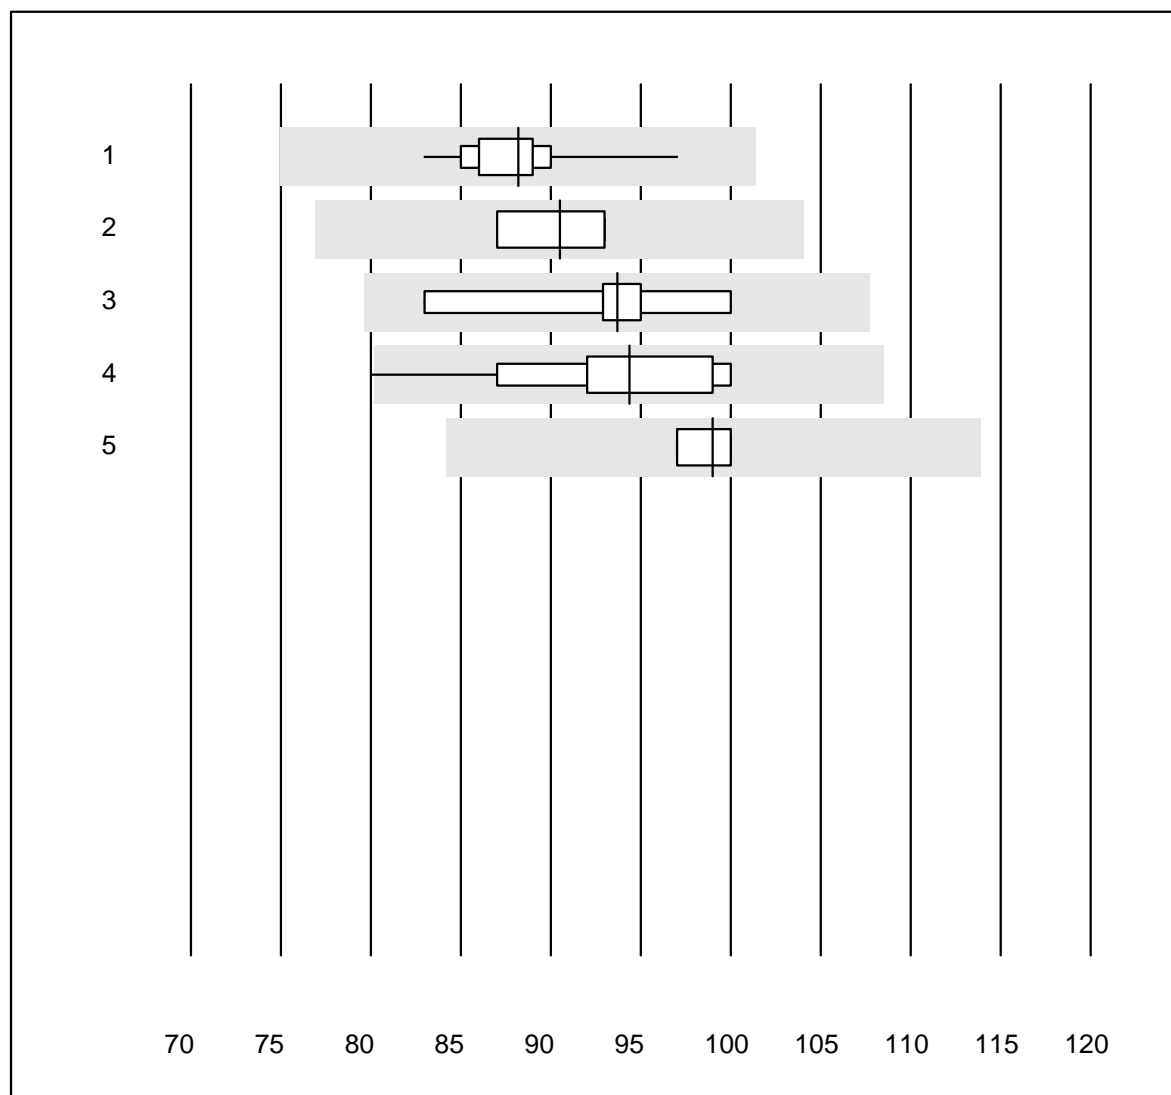


QUALAB Tolérance : 15 %

Quick N (%)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Neoplastin R	12	100.0	0.0	0.0	88	3.9	e
2 Neoplastin Plus	6	100.0	0.0	0.0	91	3.2	e
3 Innovin	10	100.0	0.0	0.0	94	5.2	e
4 toutes les méthodes	11	90.9	9.1	0.0	94	6.5	e*
5 Recombiplastin 2G	7	100.0	0.0	0.0	99	1.5	e

Faktor II

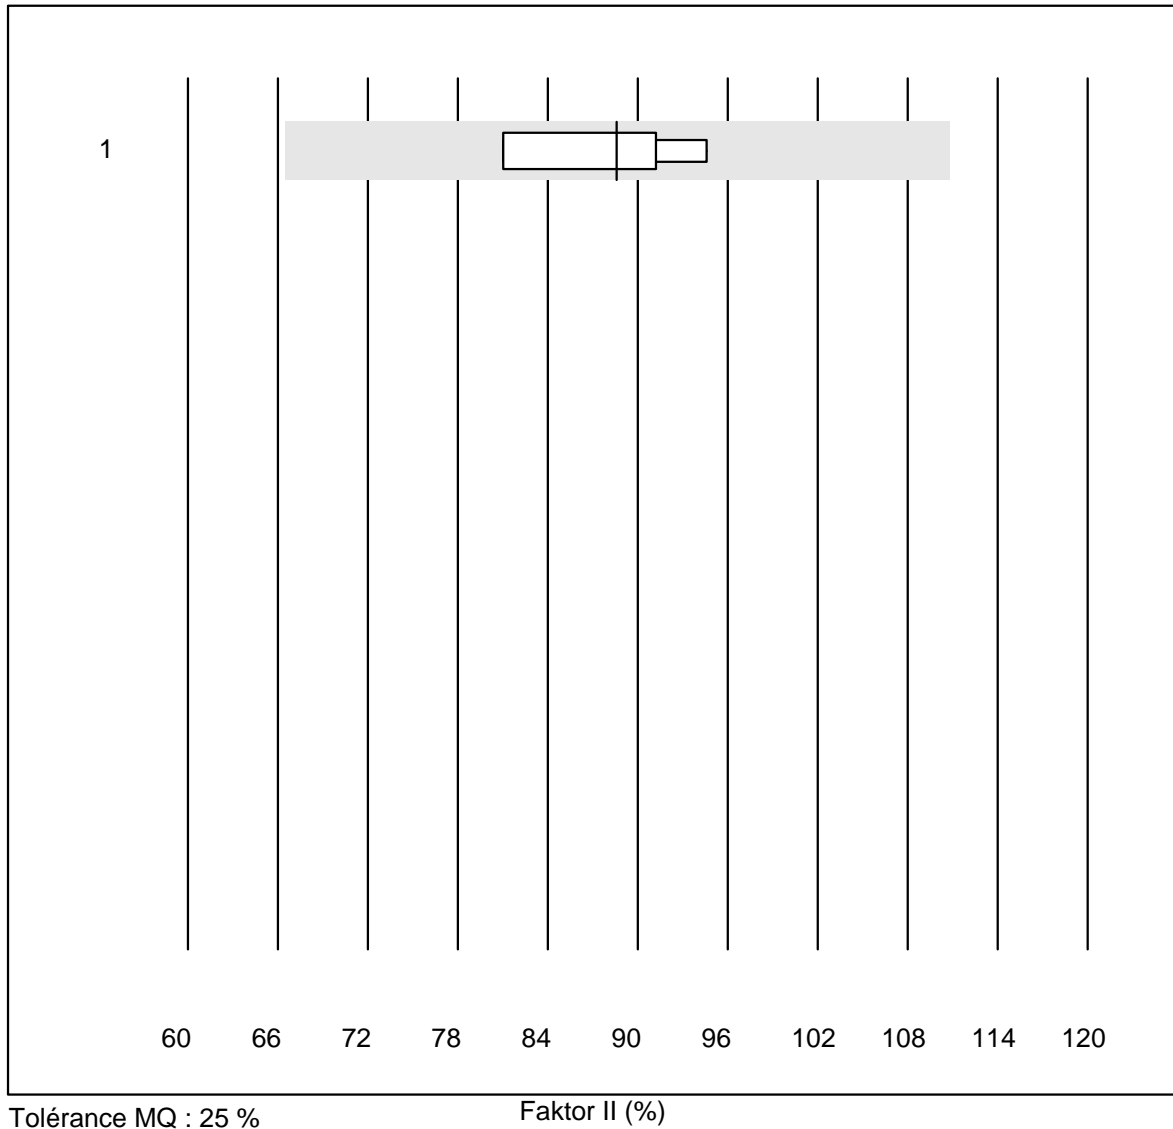


Tolérance MQ : 25 %

Faktor II (%)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	88.6	6.8	e*

Fibrinogen N

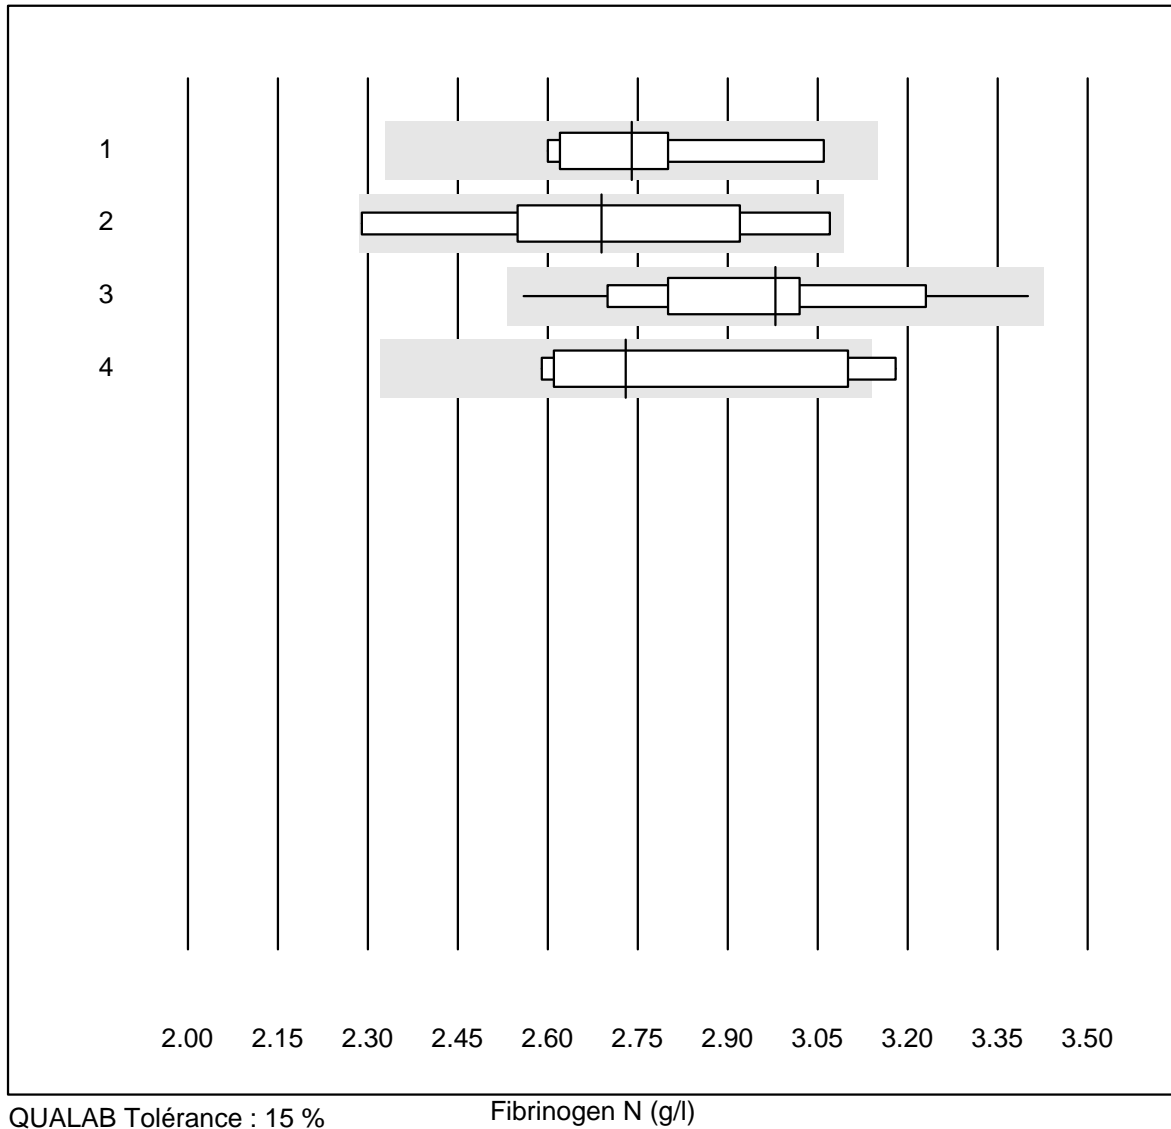

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Siemens Thrombin	6	100.0	0.0	0.0	2.74	6.2	e*
2 Autres méthodes	7	100.0	0.0	0.0	2.69	9.6	e*
3 Stago/STA	18	100.0	0.0	0.0	2.98	6.9	a
4 Fibrinogen Q.F.A.	7	85.7	14.3	0.0	2.73	8.3	e*

Faktor V

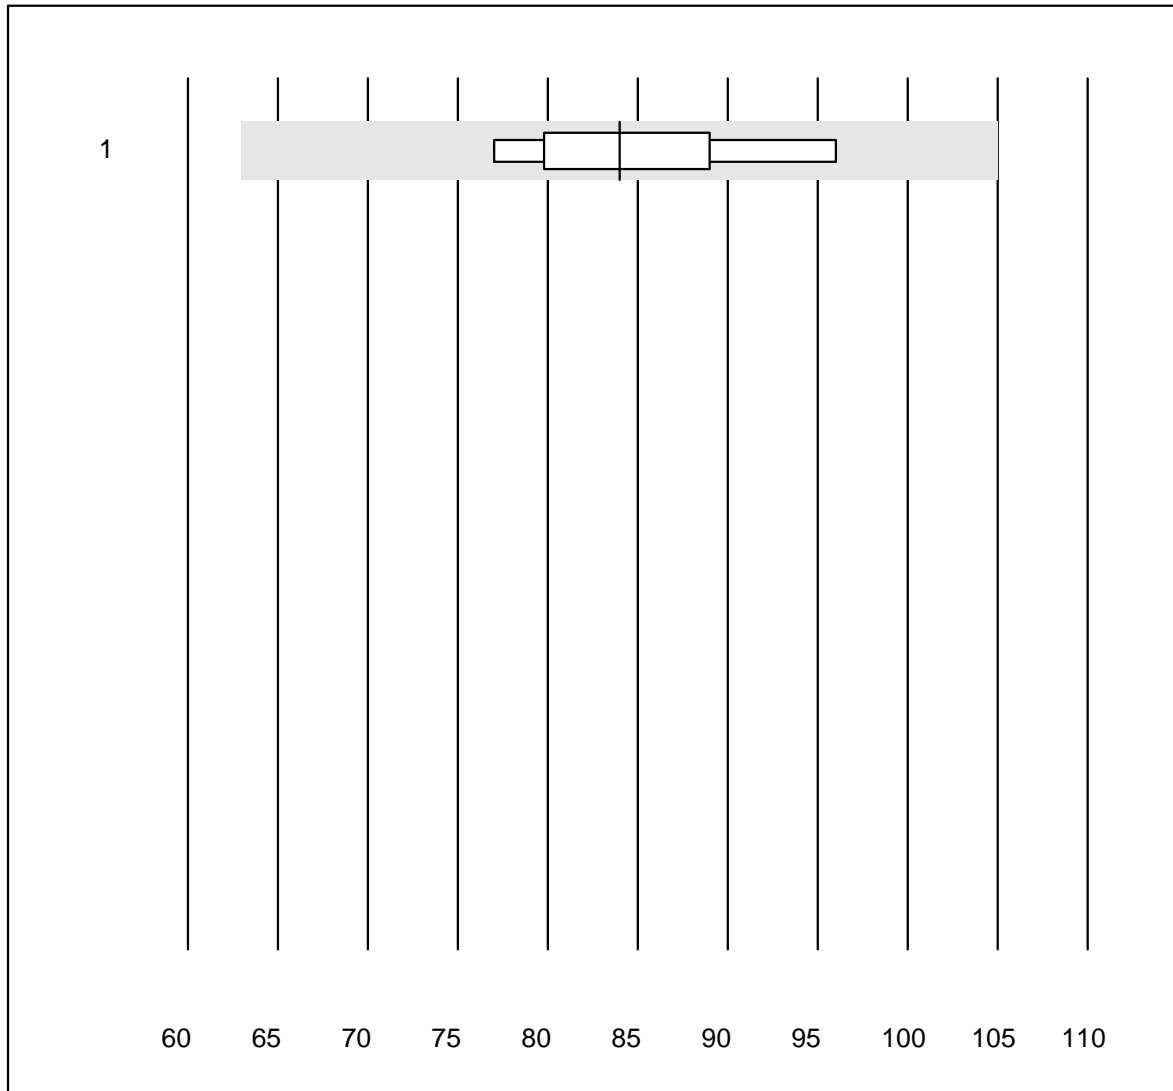


Tolérance MQ : 25 %

Faktor V (%)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	84.0	7.6	e

aPTT N

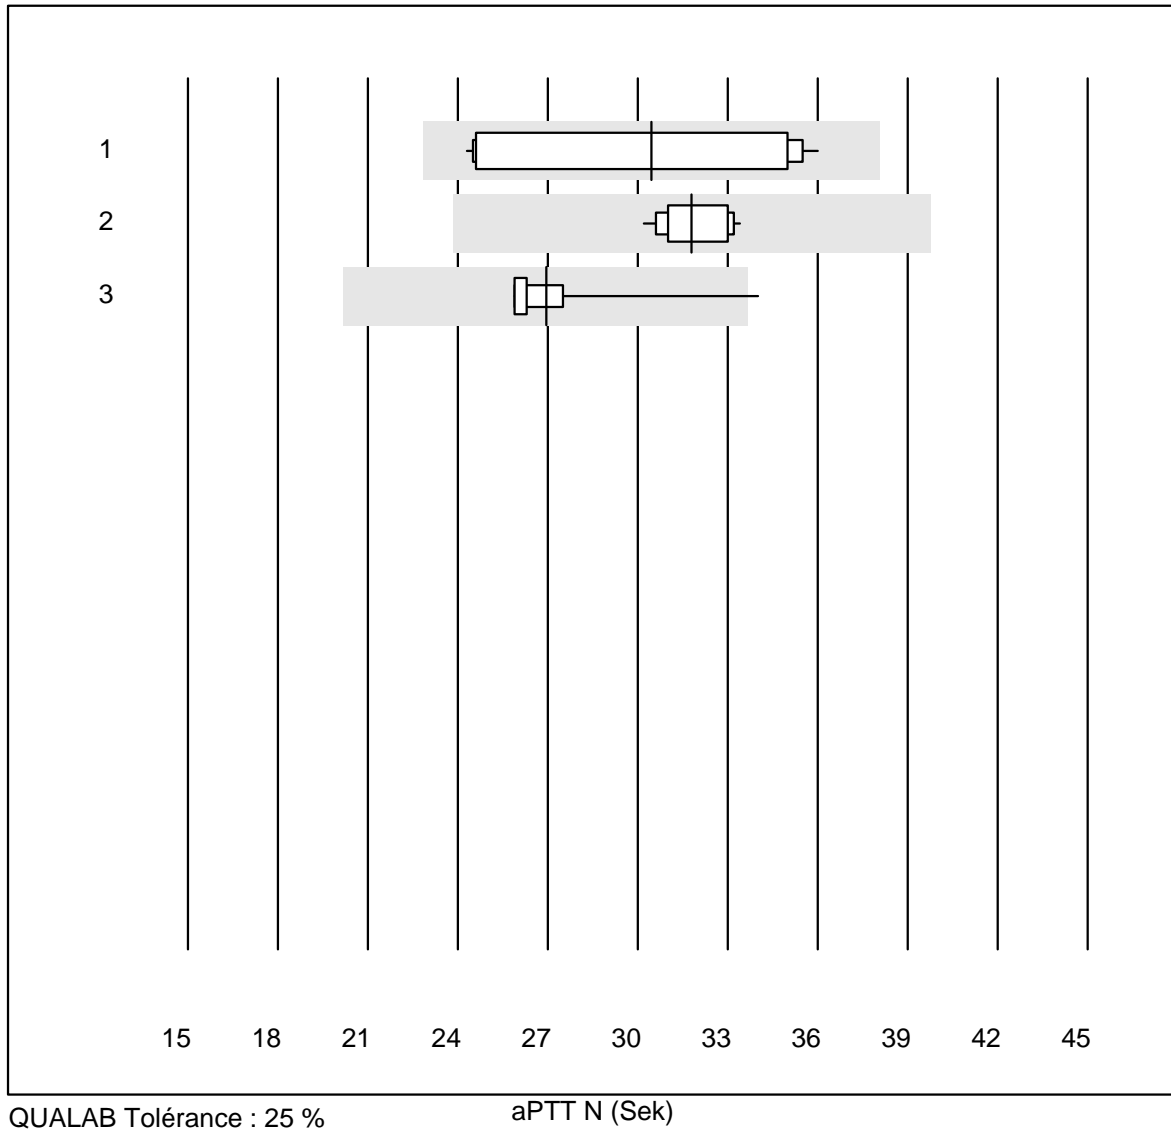


QUALAB Tolérance : 25 %

aPTT N (Sek)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Autres méthodes	12	100.0	0.0	0.0	30.5	16.2	e*
2 Stago/STA	17	100.0	0.0	0.0	31.8	3.1	e
3 aPTT-SP	10	90.0	10.0	0.0	26.9	9.4	e

Faktor VII

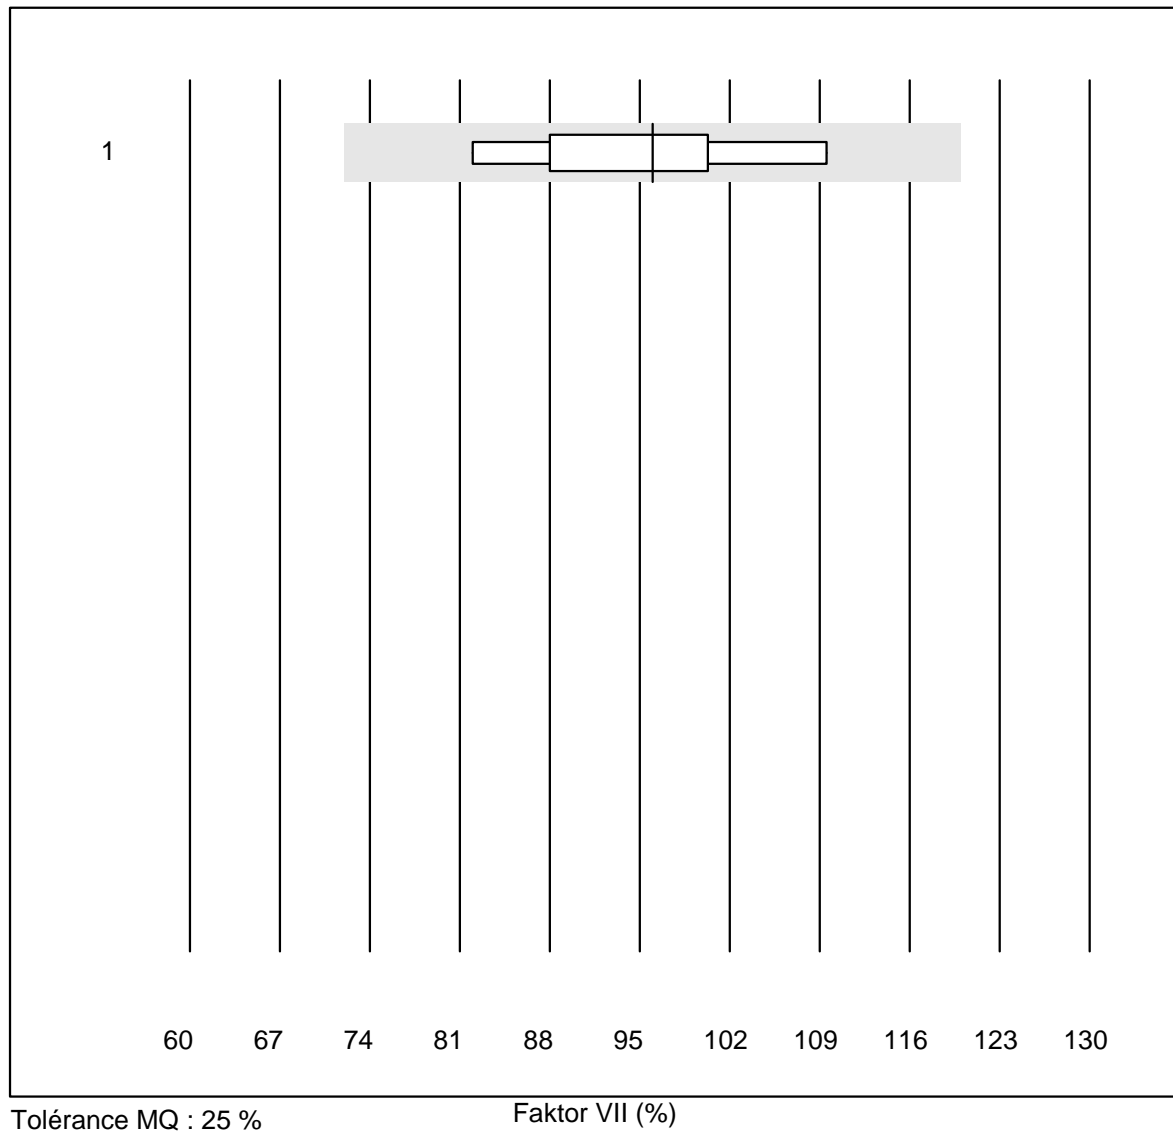

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	96.0	11.2	e*

Quick H

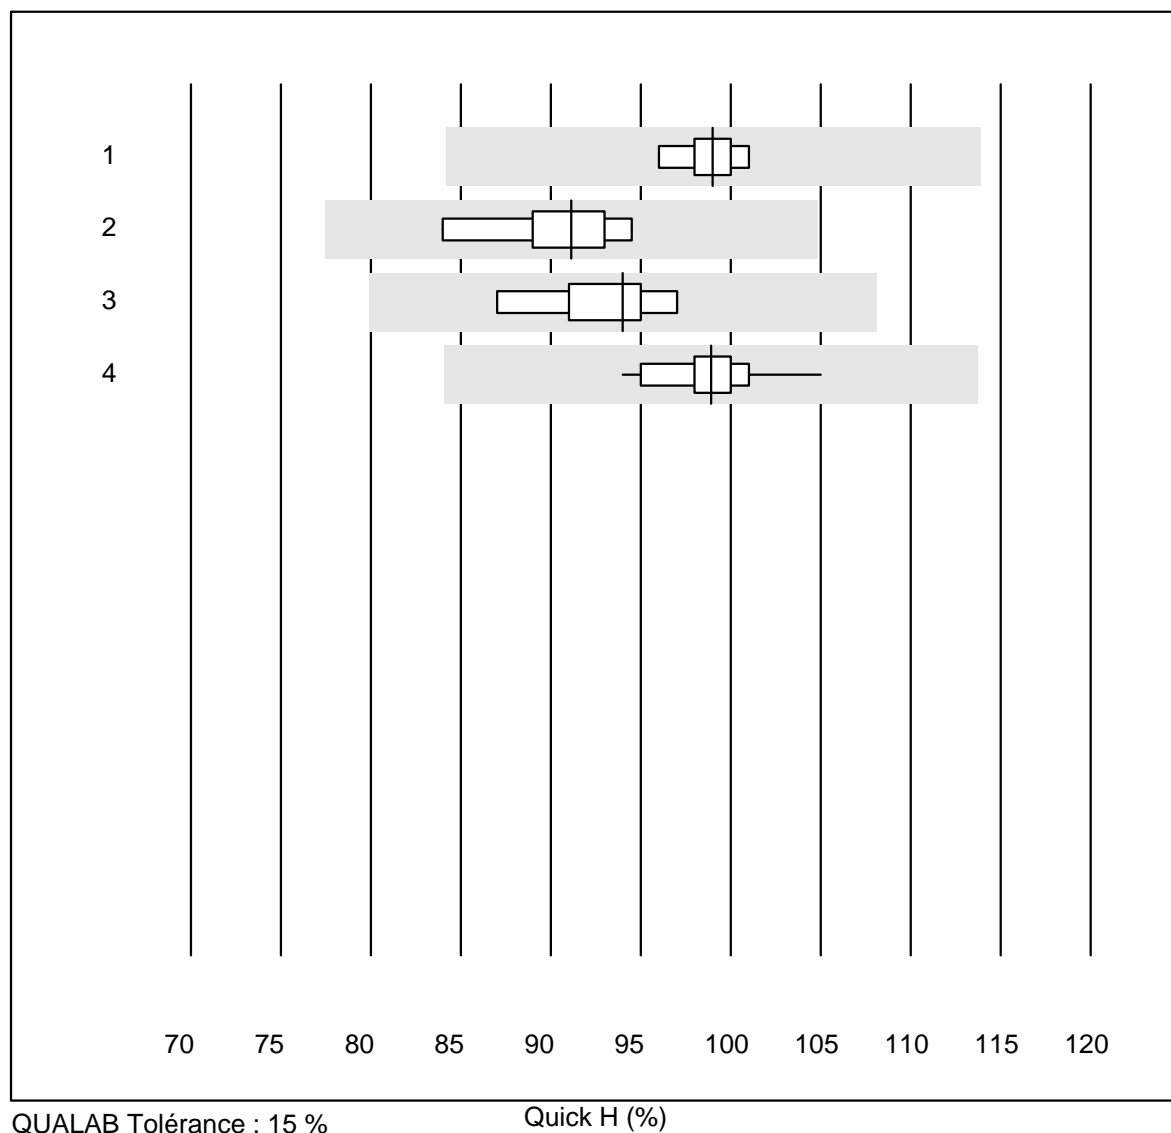


QUALAB Tolérance : 15 %

Quick H (%)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Neoplastin R	9	100.0	0.0	0.0	99	1.7	e
2 Innovin	8	100.0	0.0	0.0	91	3.6	e
3 toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	94	3.8	e
4 Recombiplastin 2G	11	100.0	0.0	0.0	99	3.0	e

Anti-FXa (unfrakt-Heparin)

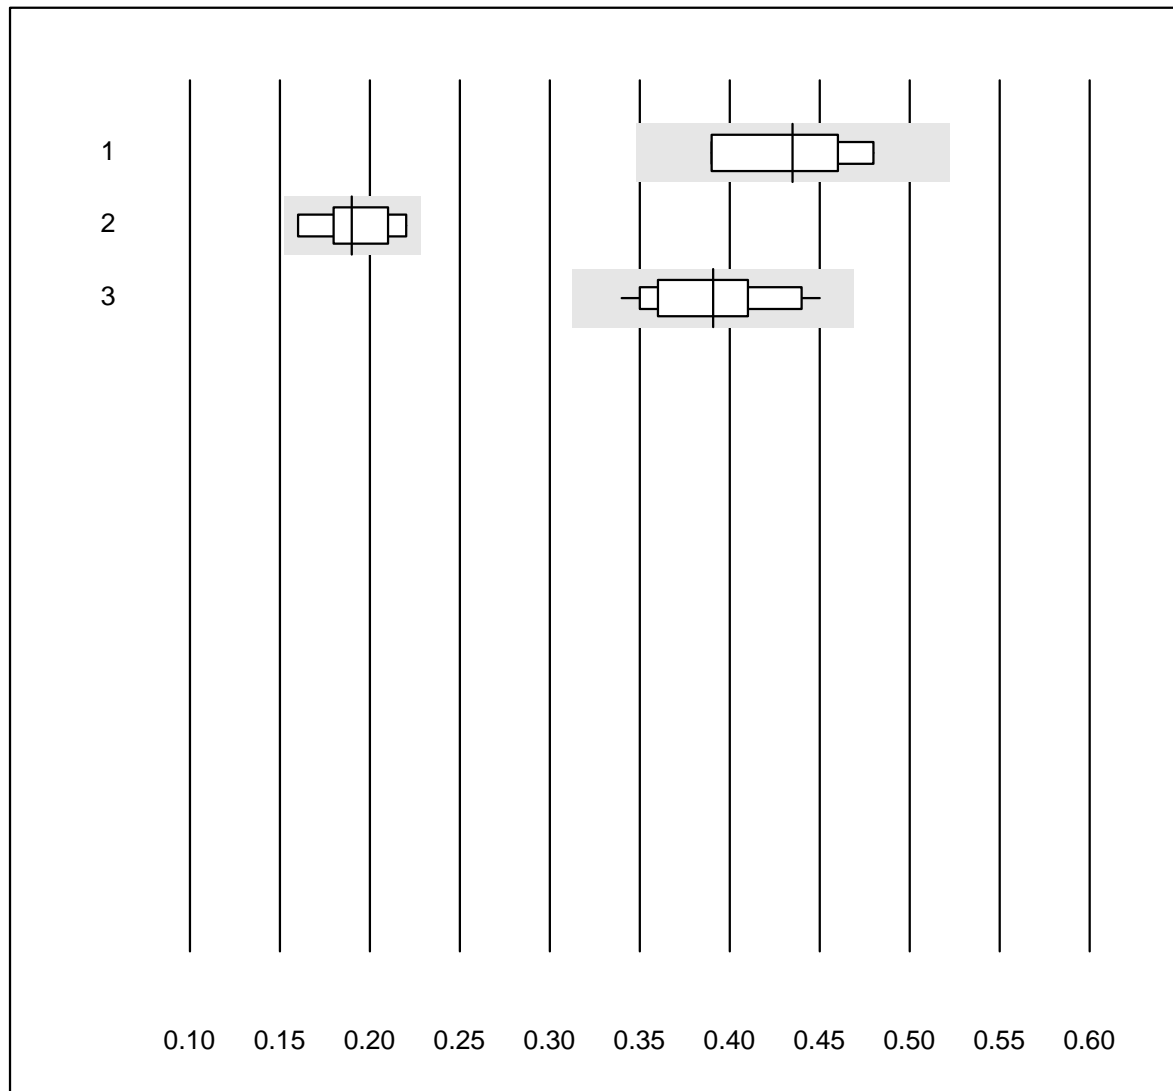


Tolérance MQ : 20 %

Anti-FXa (unfrakt-Heparin) (IU/ml)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	0.44	9.7	e*
2 Stago/STA	7	100.0	0.0	0.0	0.19	10.5	e*
3 ACL	12	100.0	0.0	0.0	0.39	8.8	e*

Fibrinogen H

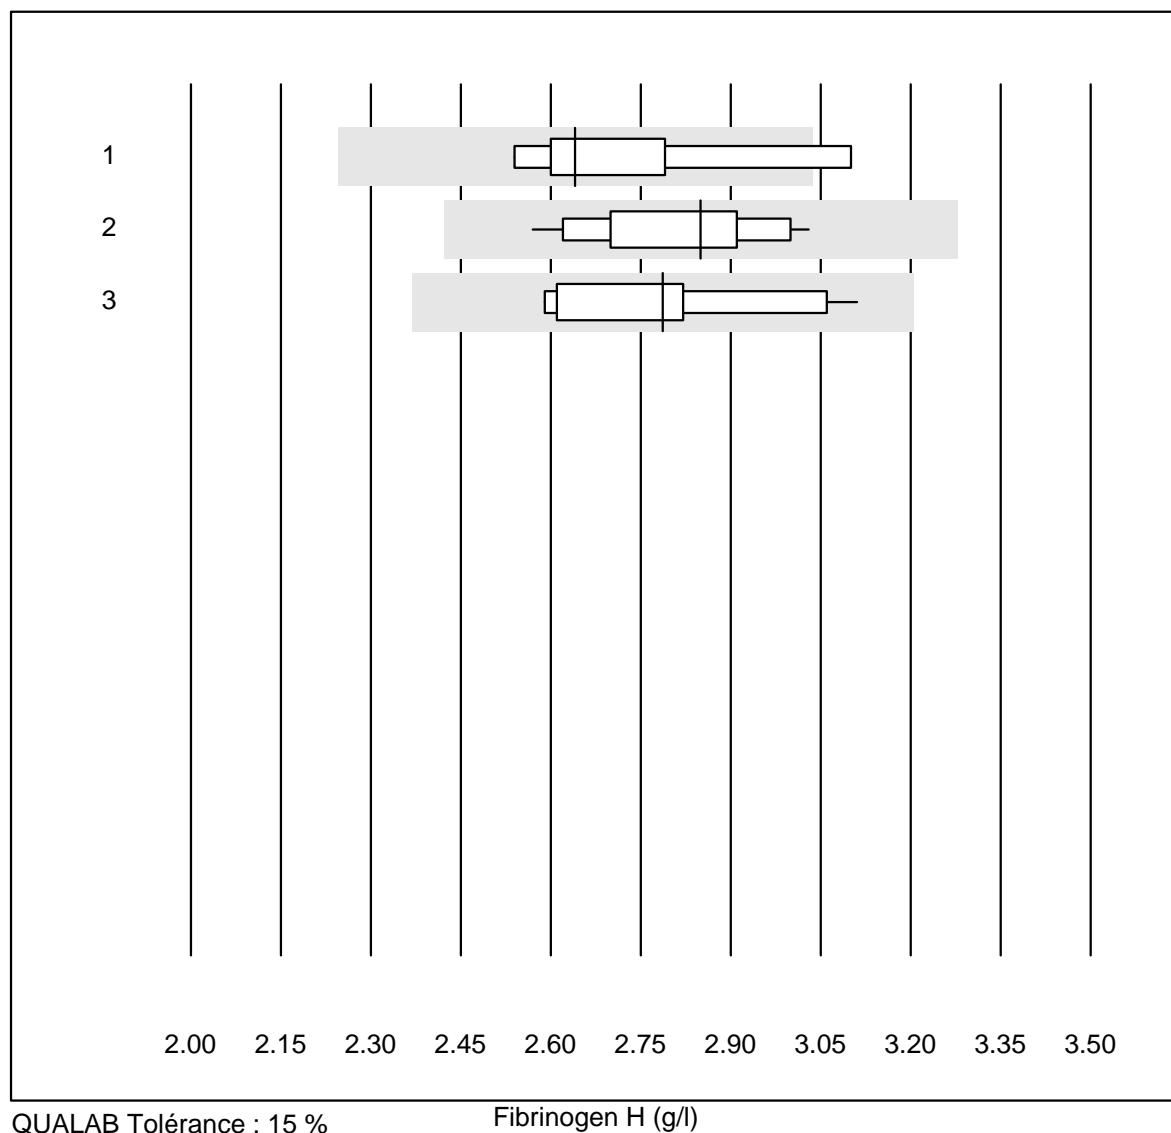


QUALAB Tolérance : 15 %

Fibrinogen H (g/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Autres méthodes	5	80.0	20.0	0.0	2.64	8.2	e*
2 Stago/STA	12	100.0	0.0	0.0	2.85	5.2	e
3 Fibrinogen Q.F.A.	12	100.0	0.0	0.0	2.79	6.1	e

aPTT H

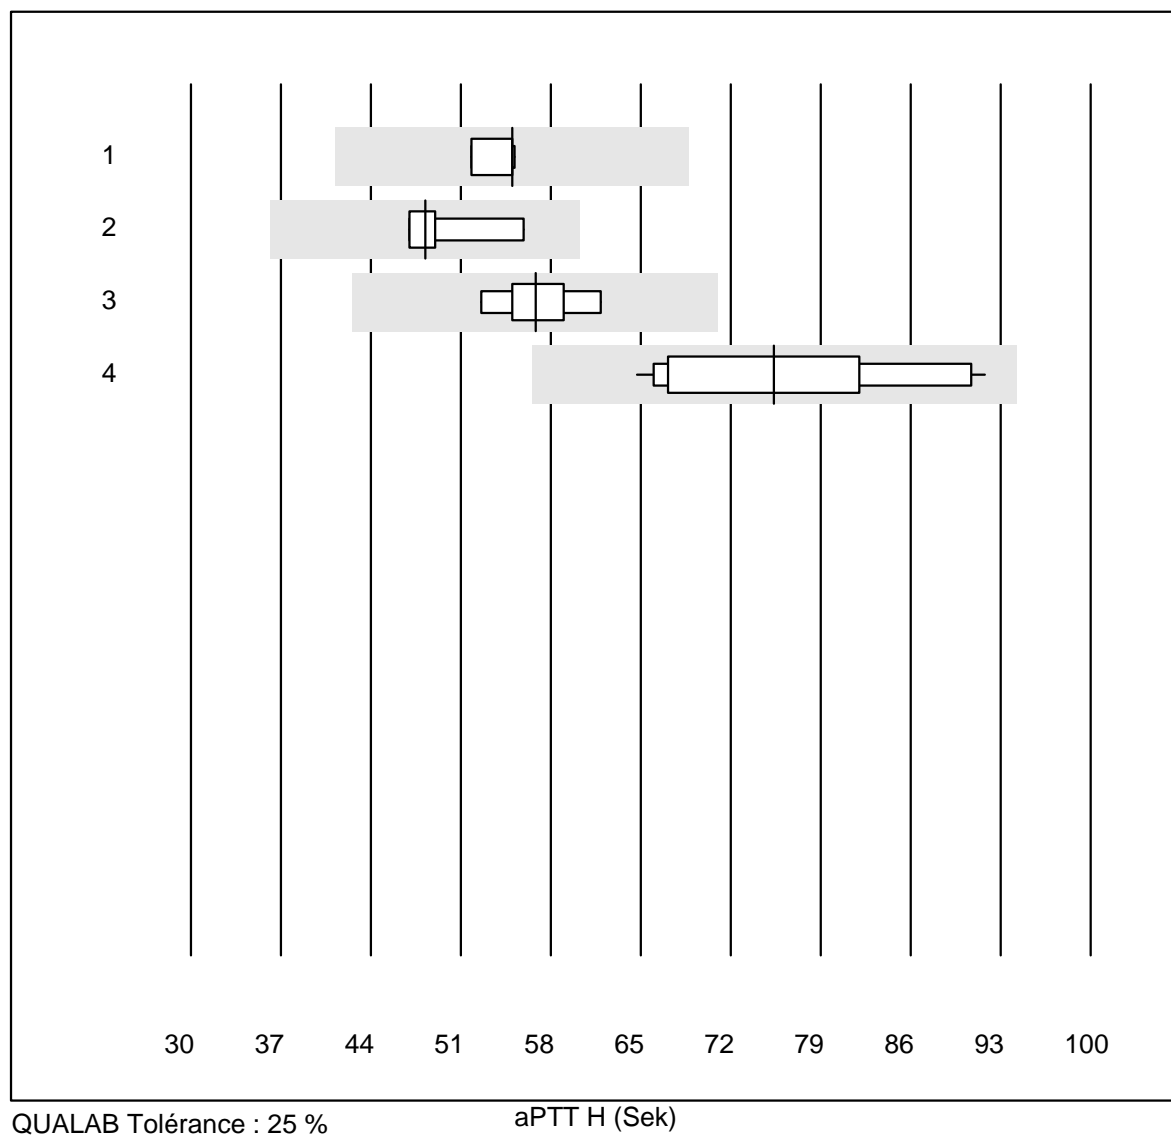


QUALAB Tolérance : 25 %

aPTT H (Sek)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Actin FS	4	100.0	0.0	0.0	55.0	3.0	e
2 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	48.3	8.3	e*
3 Stago/STA	9	100.0	0.0	0.0	56.8	5.0	e
4 aPTT-SP	12	100.0	0.0	0.0	75.4	13.1	e*

D-Dimères

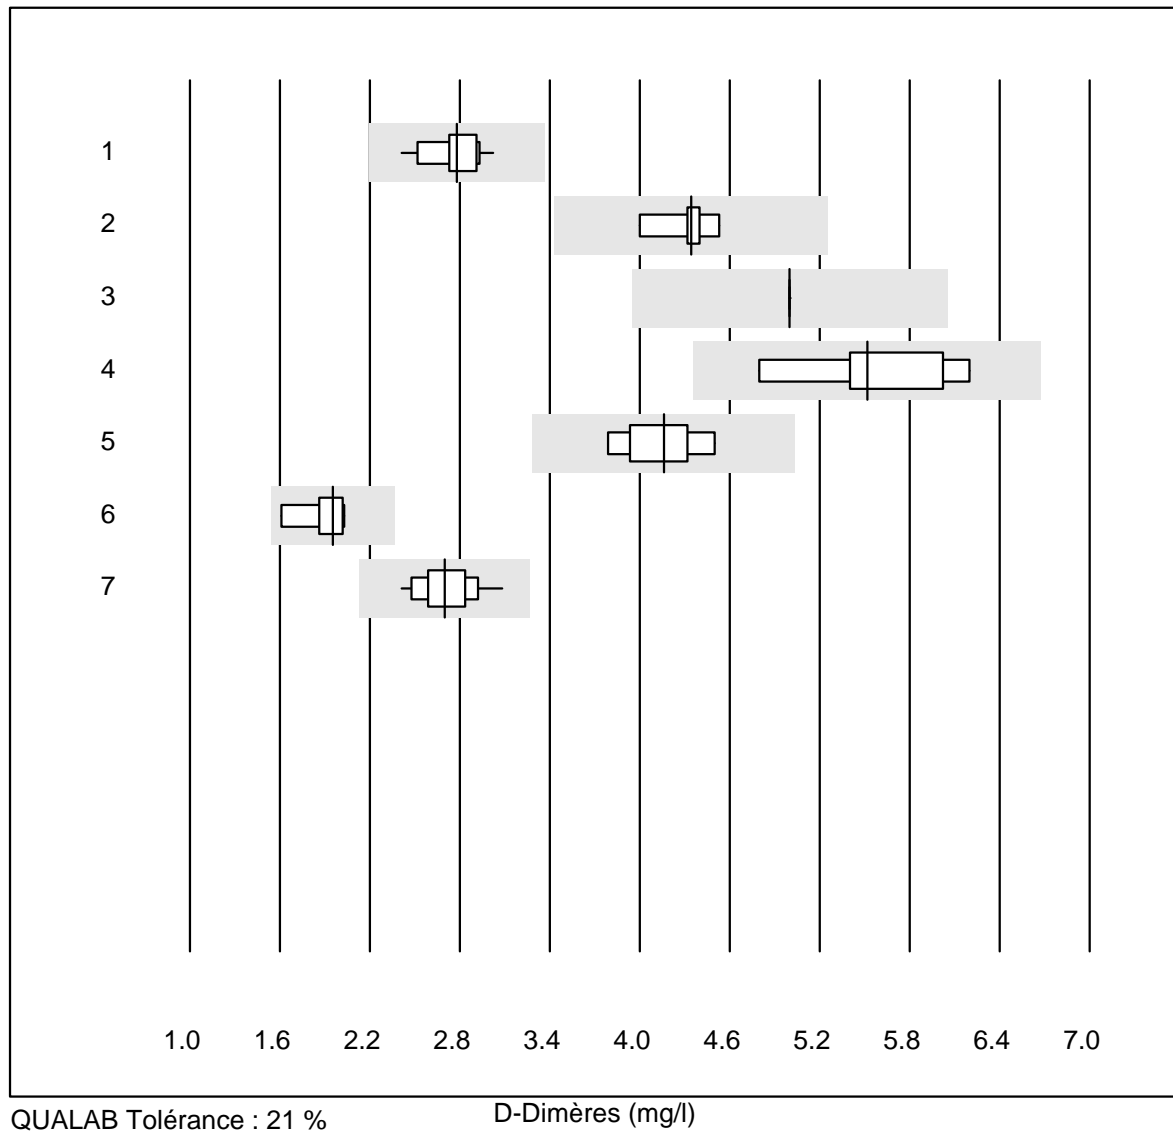


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 STA Liatest	13	100.0	0.0	0.0	2.78	6.2	e
2 Siemens Innovance	6	100.0	0.0	0.0	4.35	4.1	e
3 Pathfast	8	100.0	0.0	0.0	5.00	0.0	e
4 Eurolyser	6	100.0	0.0	0.0	5.52	8.9	e*
5 ACL	9	77.8	0.0	22.2	4.16	5.7	e
6 AQT 90 FLEX	8	100.0	0.0	0.0	1.96	7.2	e*
7 VIDAS	18	100.0	0.0	0.0	2.70	6.7	e

CoaguChek APTT

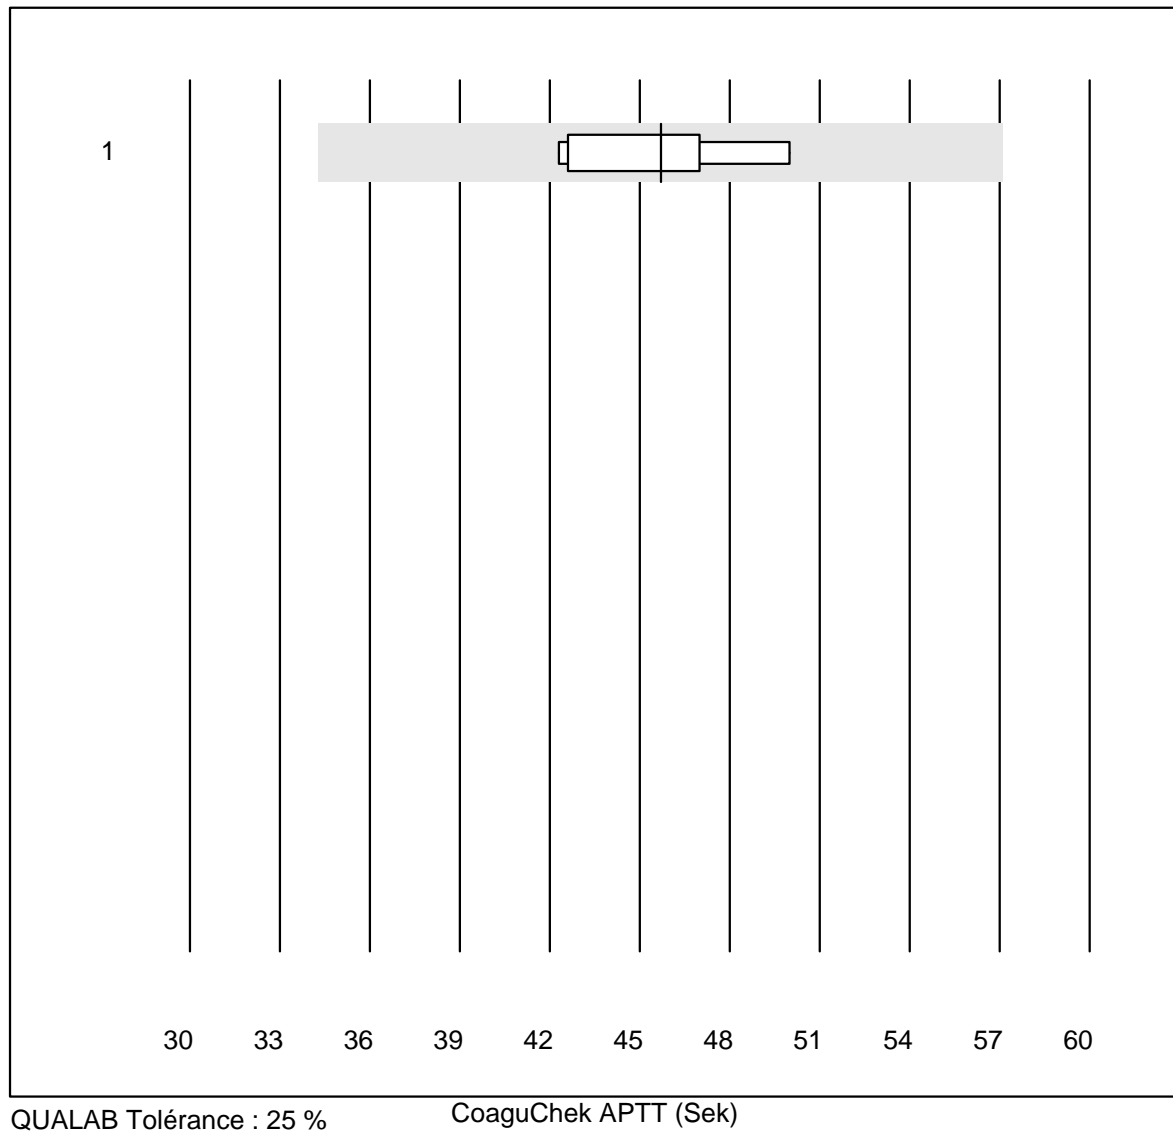

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 CoaguChek Pro II	8	100.0	0.0	0.0	45.7	6.0	e

INR CCXS

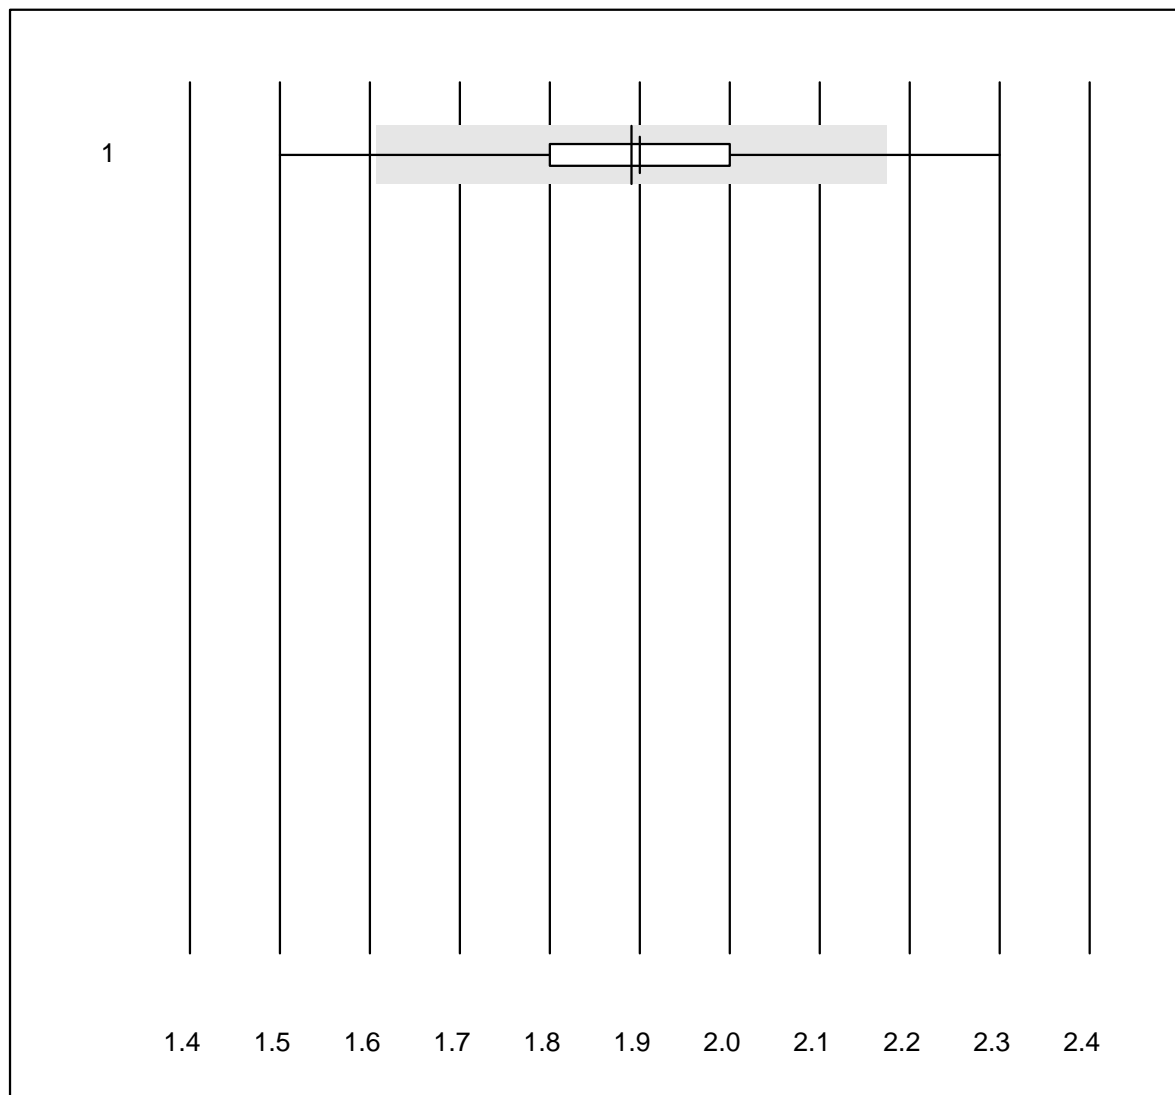


QUALAB Tolérance : 15 %

INR CCXS ()


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 CoaguChek XS	1674	98.8	0.5	0.7	1.9	3.8	e

INR HC

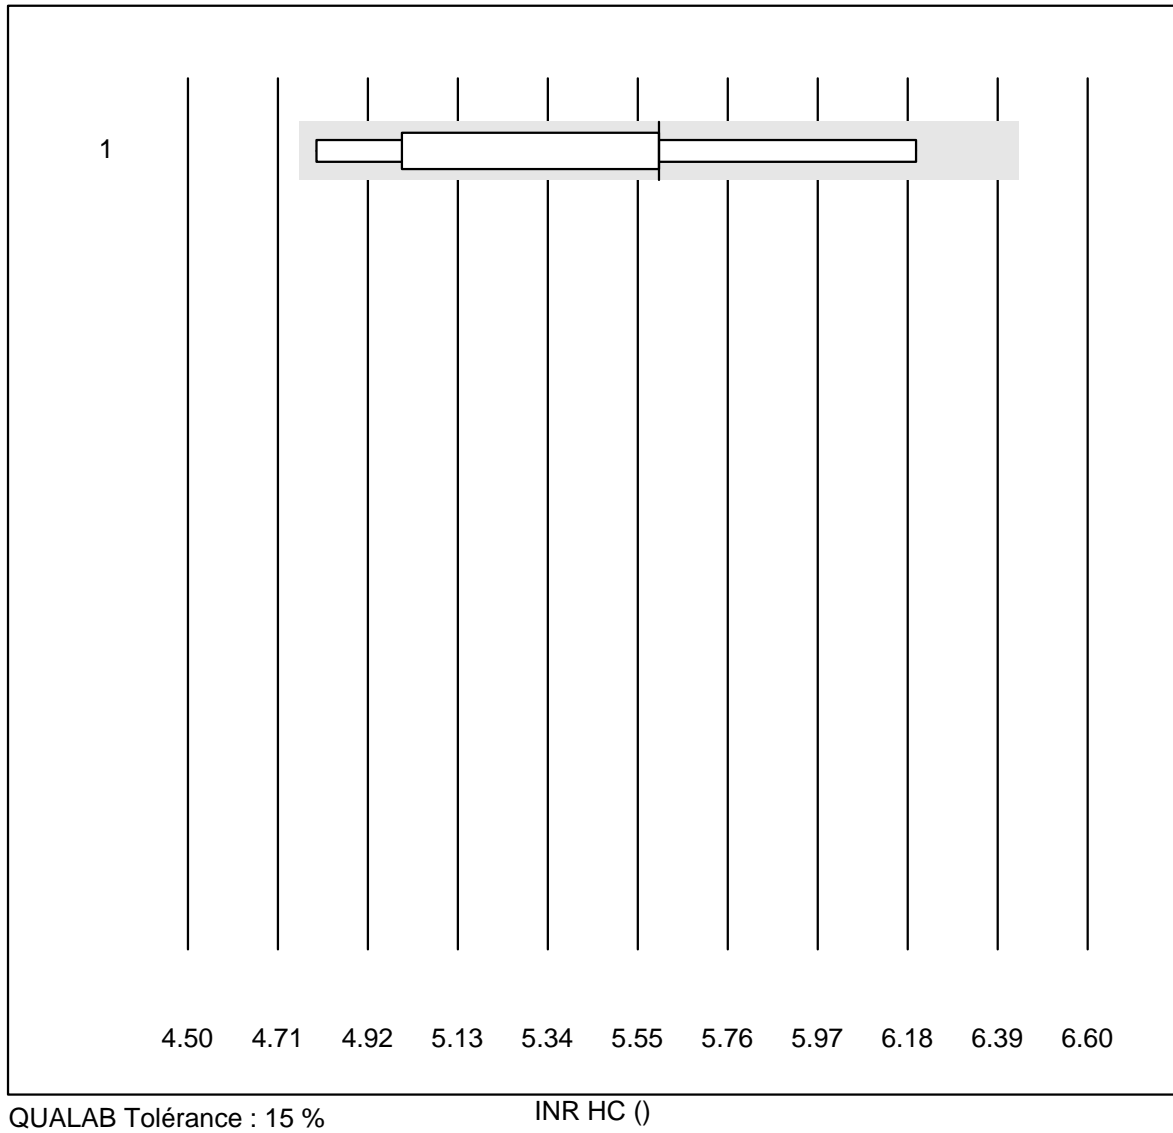


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Hemochron j.	8	100.0	0.0	0.0	5.6	8.7	e*

INR MI

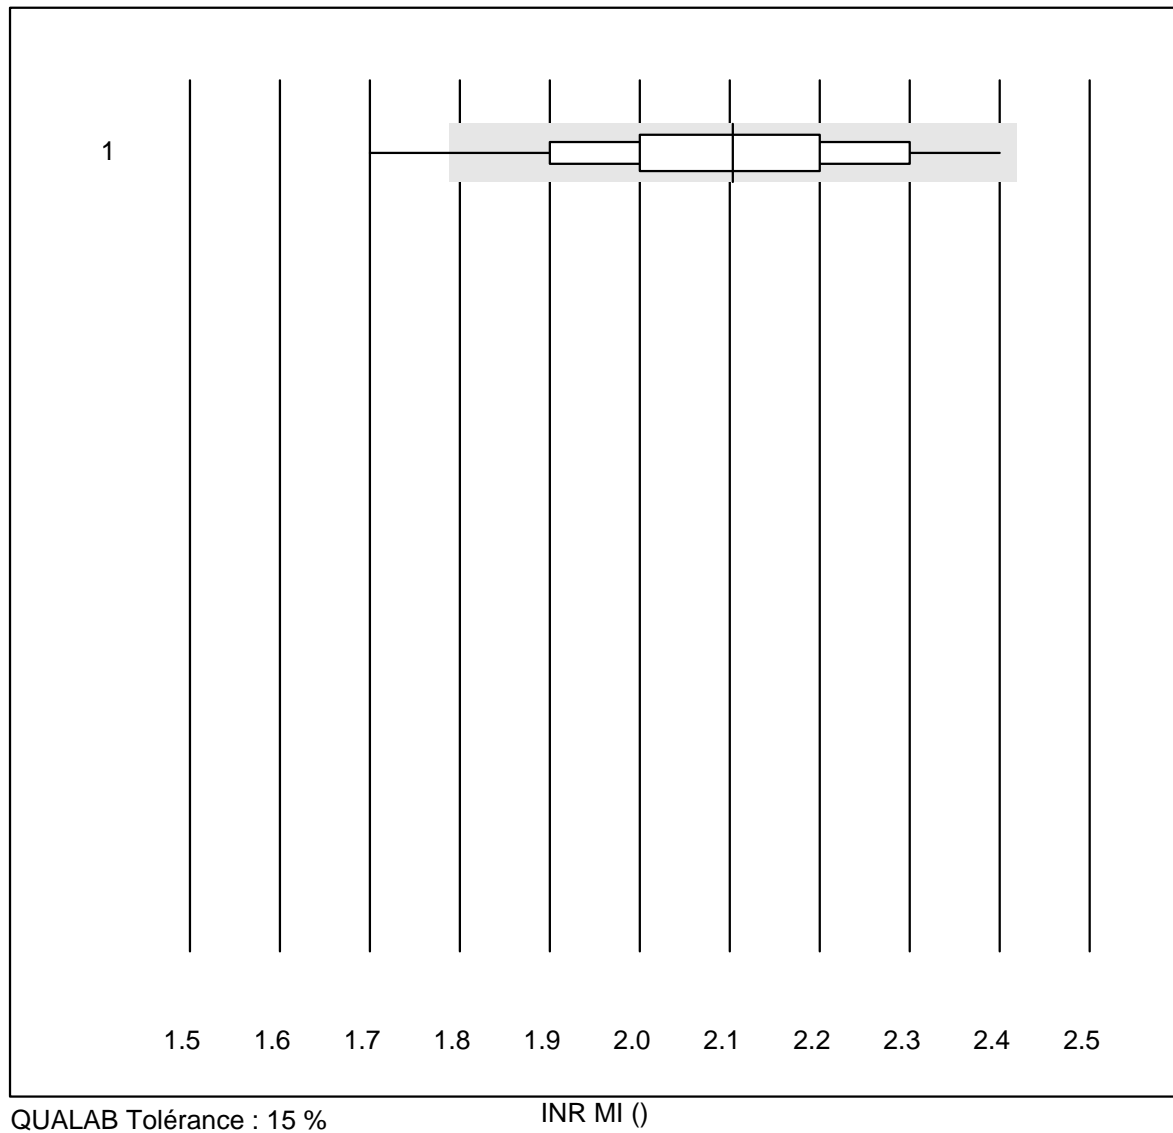

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 MicroINR	125	84.8	2.4	12.8	2.1	7.9	e

INR Xprecia

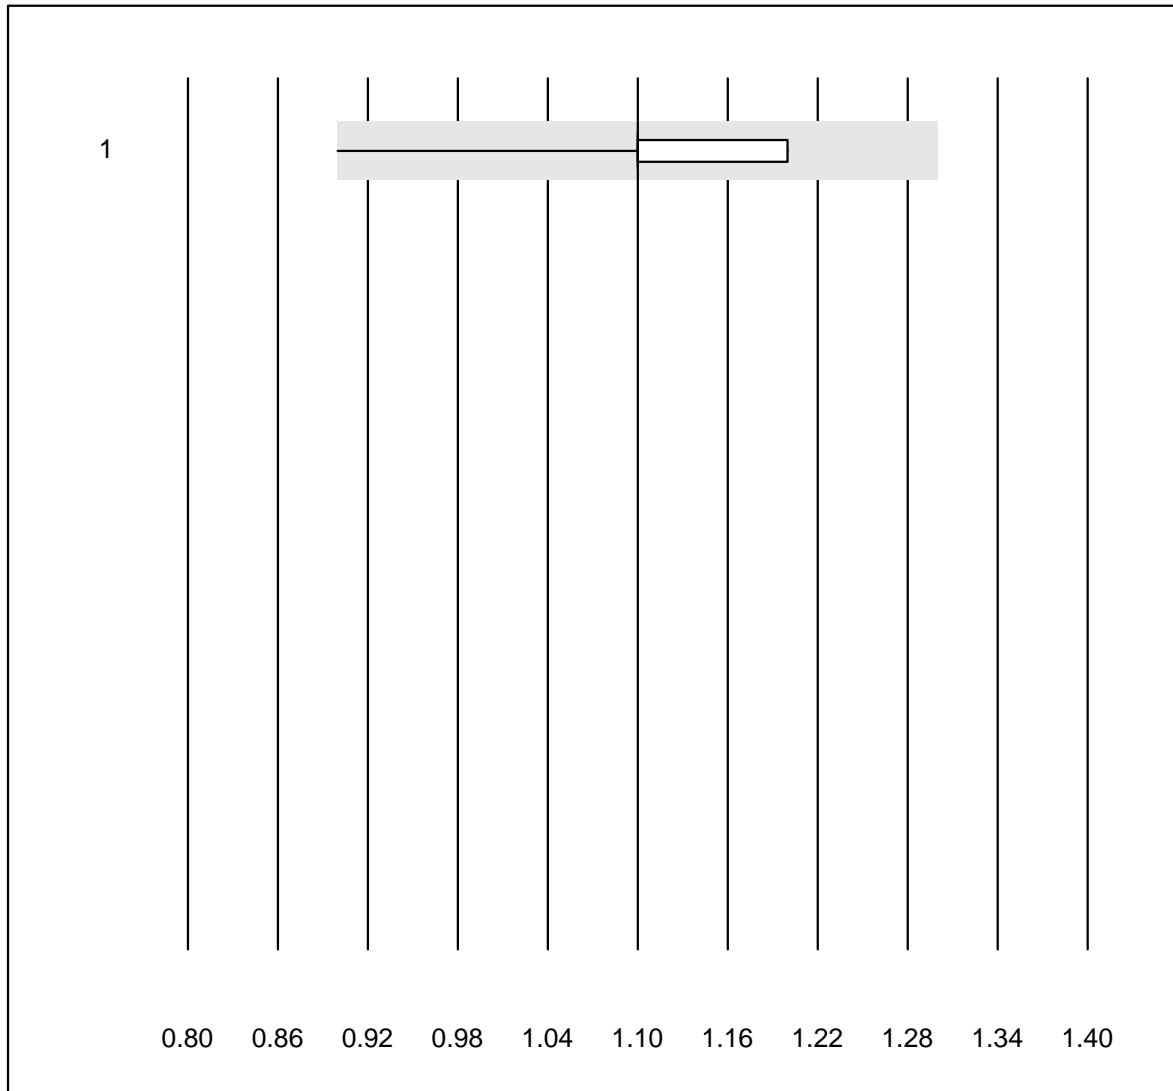


QUALAB Tolérance : 15 %
(< 1.3: +/- 0.2)

INR Xprecia ()

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Xprecia	62	95.2	4.8	0.0	1.1	5.5	e

INR Lumira Dx

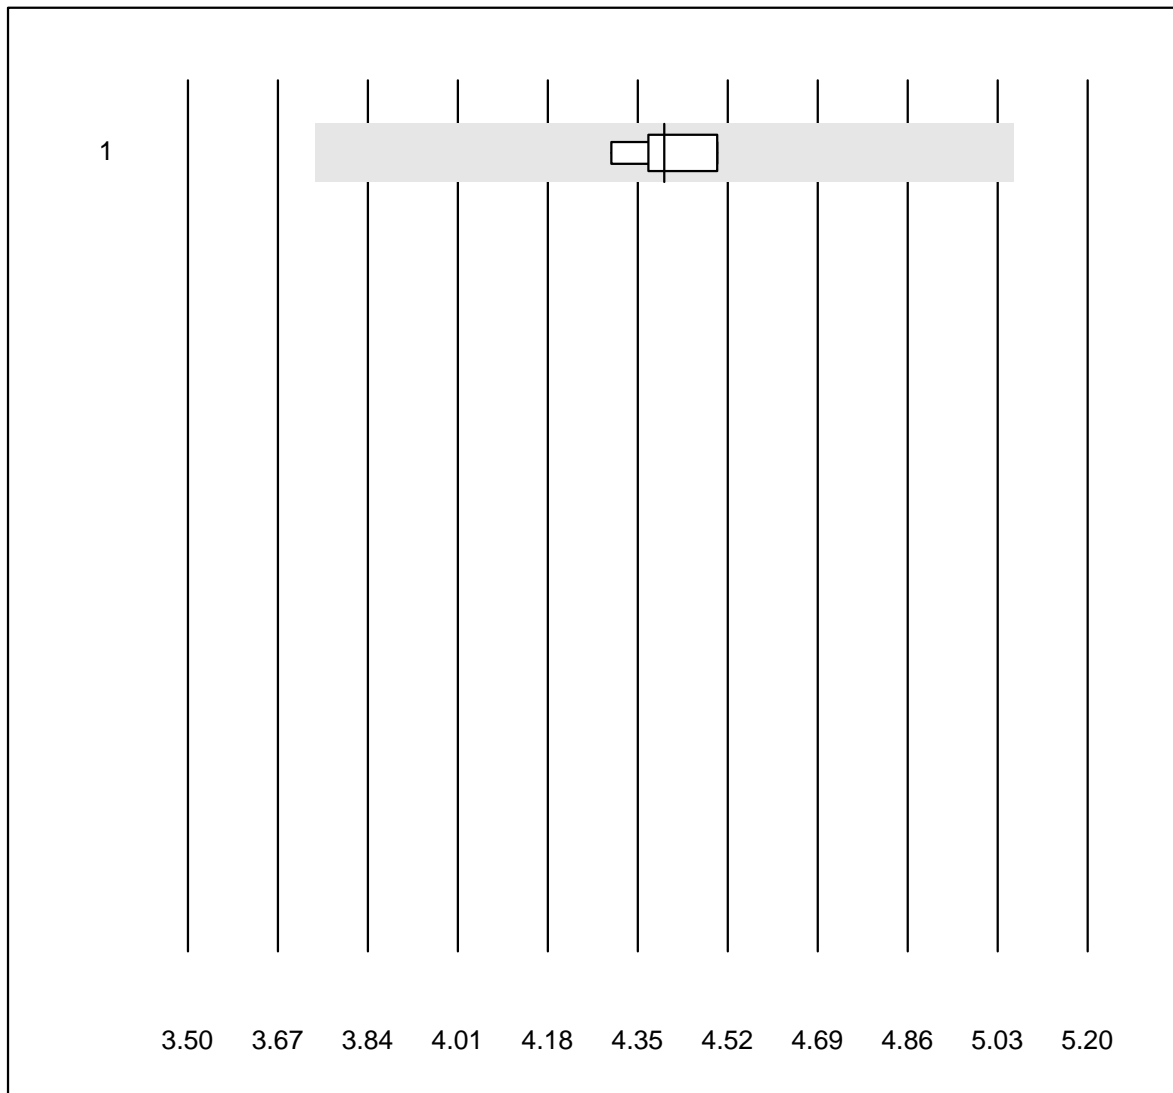


QUALAB Tolérance : 15 %

INR Lumira Dx ()

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Lumira Dx	5	100.0	0.0	0.0	4.4	2.0	e

Anti-FXa (LMW-Heparin)

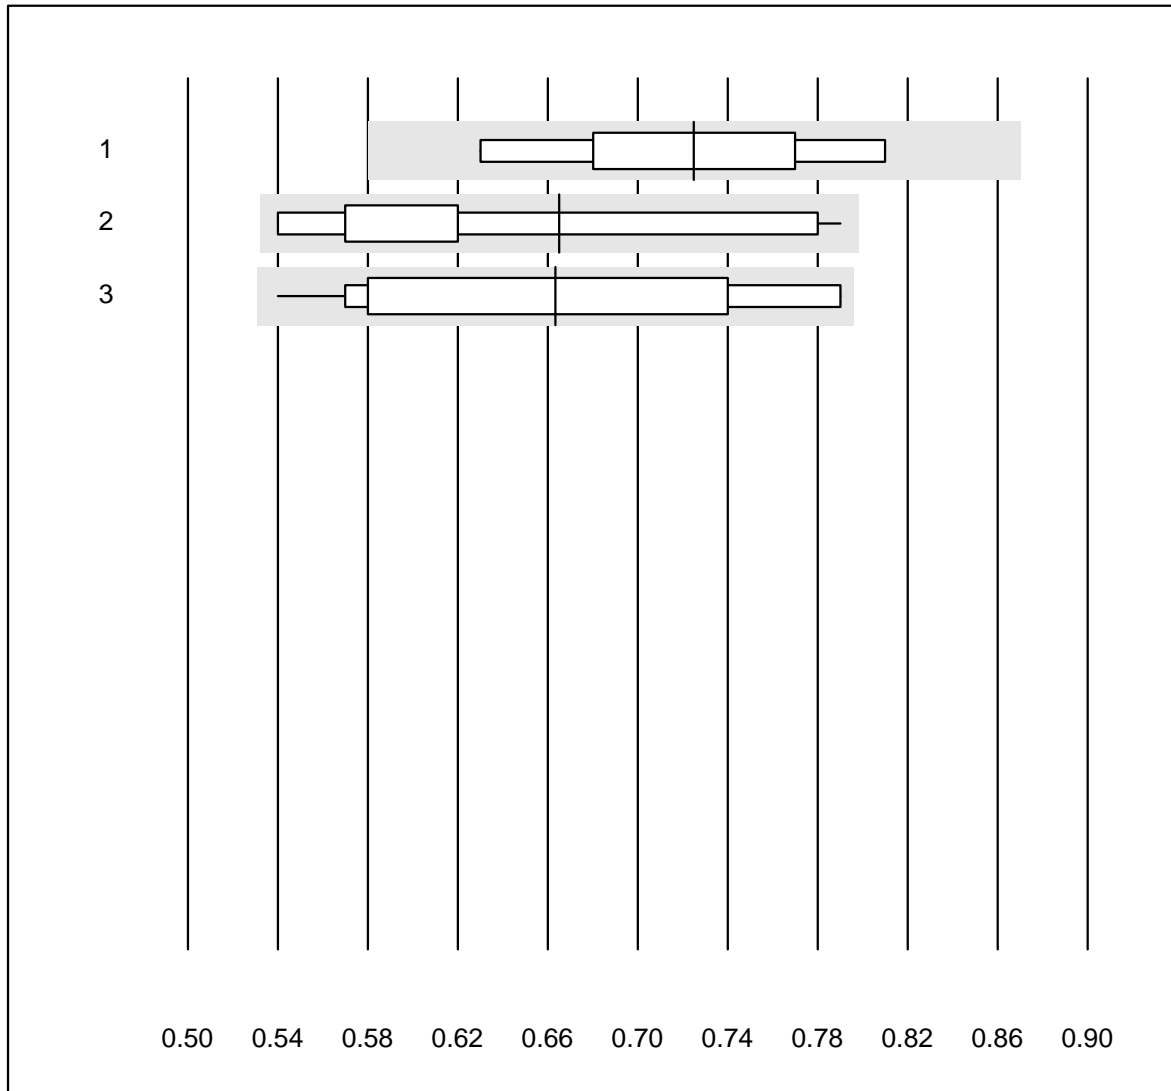


Tolérance MQ : 20 %

Anti-FXa (LMW-Heparin) (IU/ml)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	0.73	9.3	e*
2 Stago/STA	10	100.0	0.0	0.0	0.67	14.5	a
3 ACL	12	100.0	0.0	0.0	0.66	14.1	e*

Anti-FXa (Rivaroxaban)

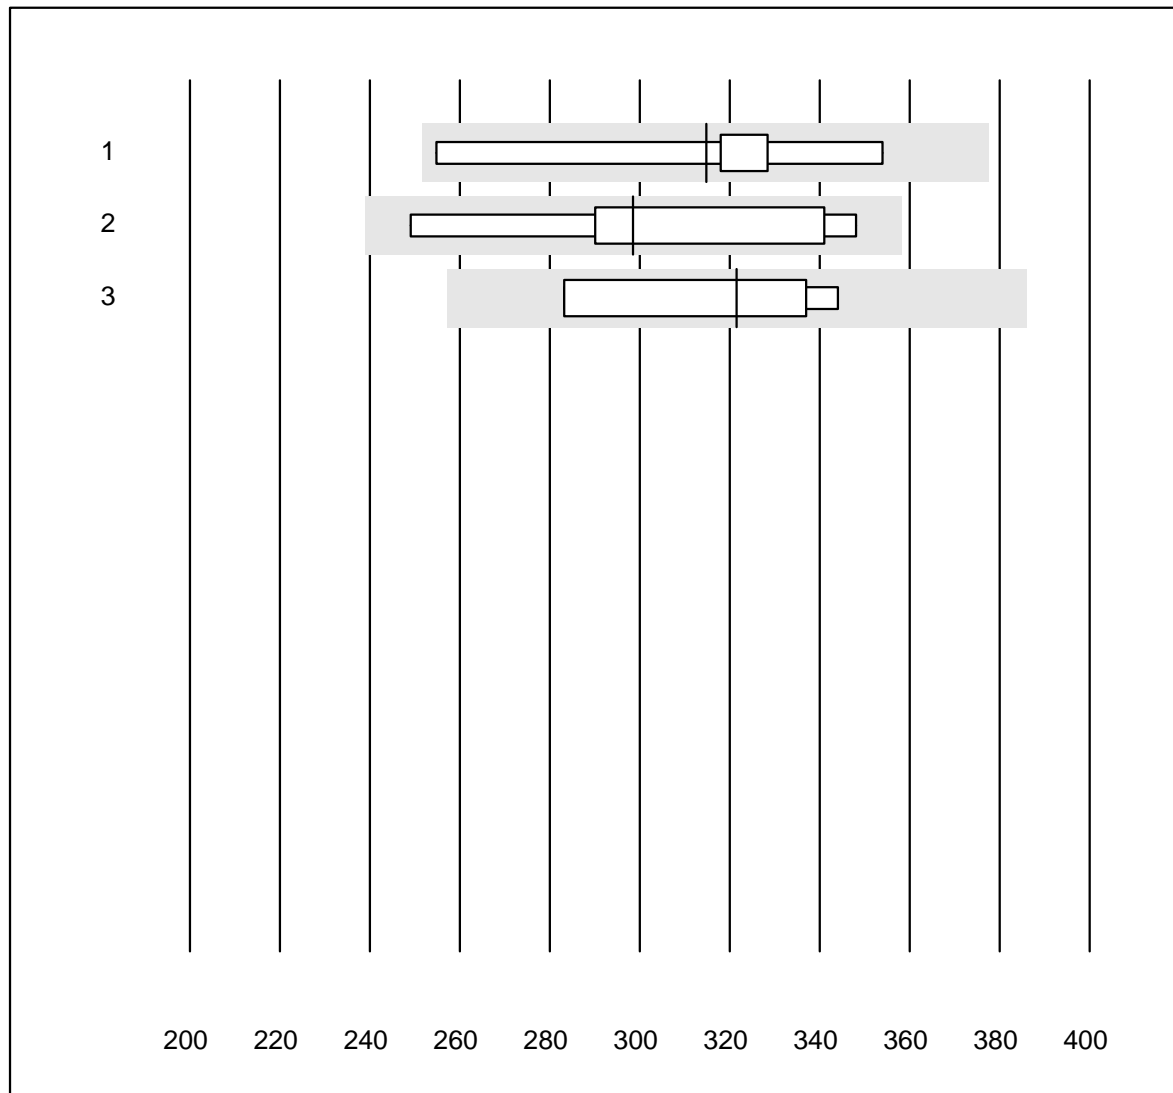


Tolérance MQ : 20 %

Anti-FXa (Rivaroxaban) (µg/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	9	100.0	0.0	0.0	314.75	8.9	a
2 Stago/STA	8	100.0	0.0	0.0	298.50	10.6	a
3 ACL	4	100.0	0.0	0.0	321.50	8.9	e*

Anti-FXa (Apixaban)

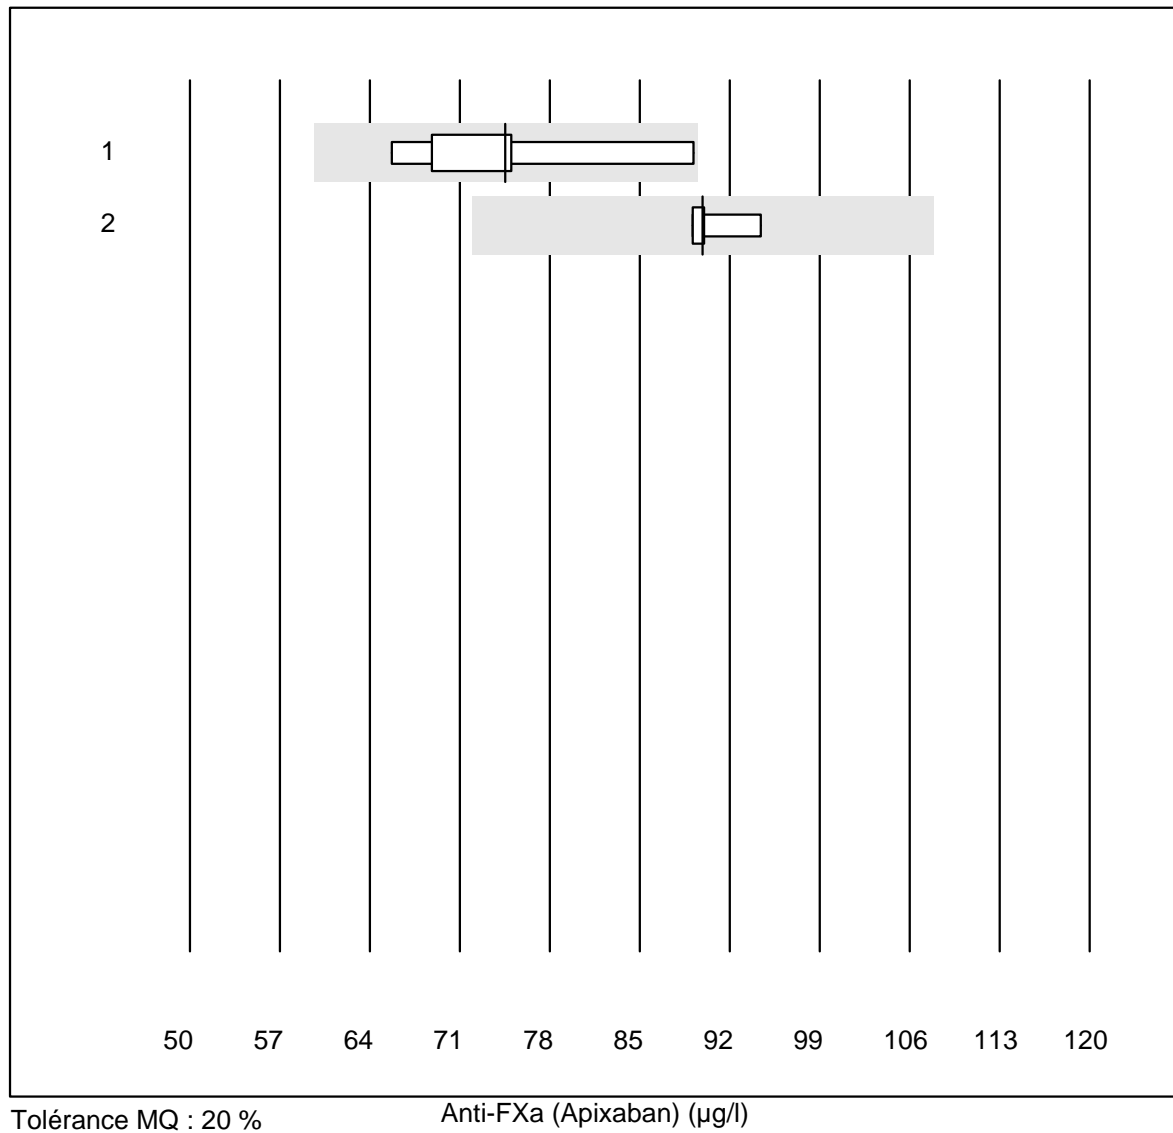


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	74.54	11.4	a
2 ACL	4	100.0	0.0	0.0	89.90	2.7	e

Anti-FXa (Edoxaban)

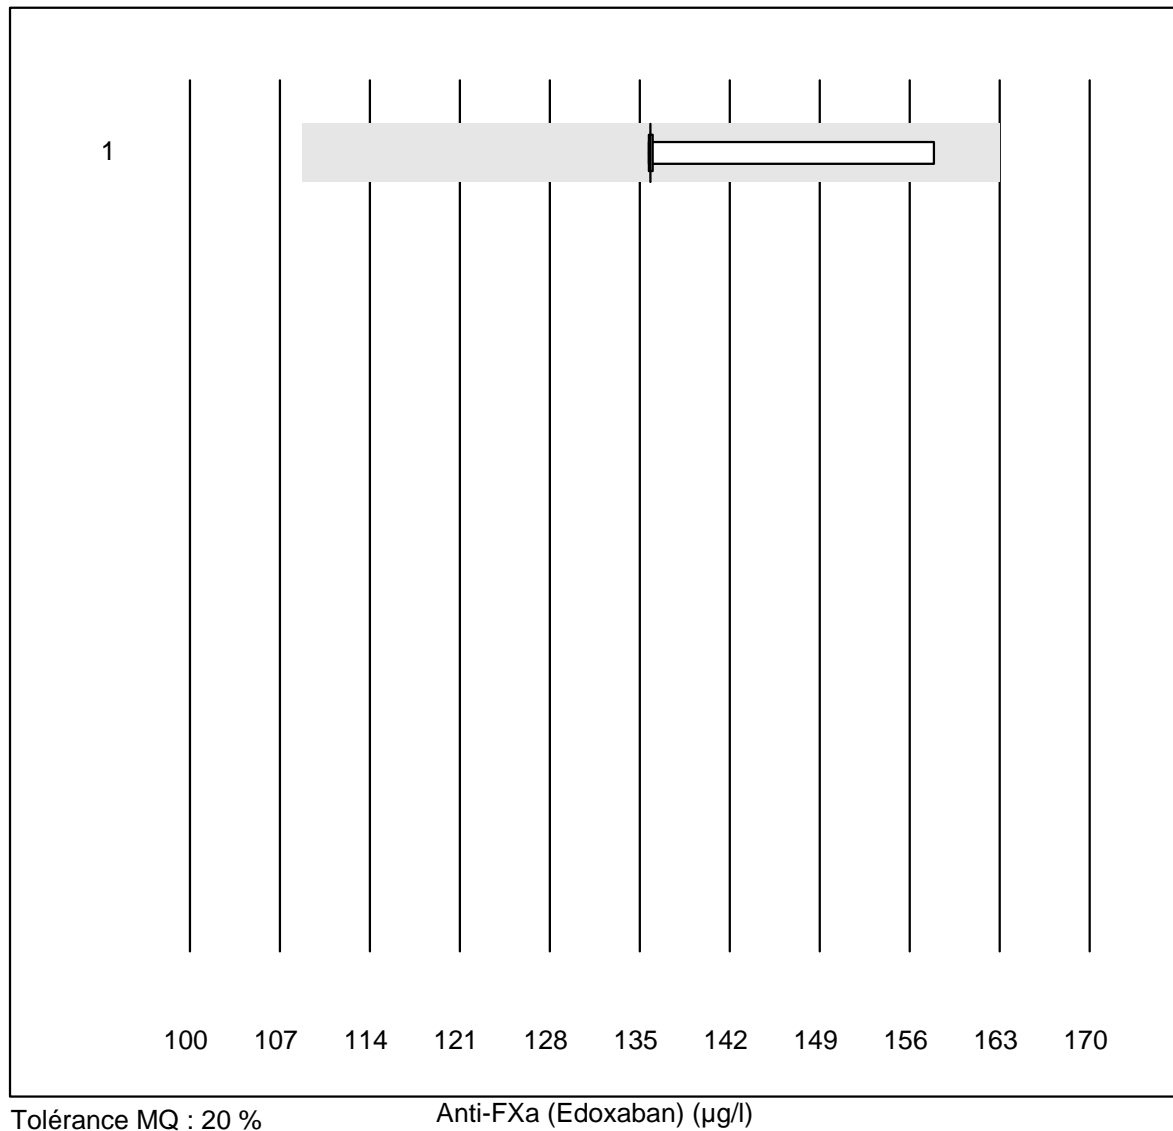

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	135.85	7.8	e*

Anti-FIIa (Dabigatran)

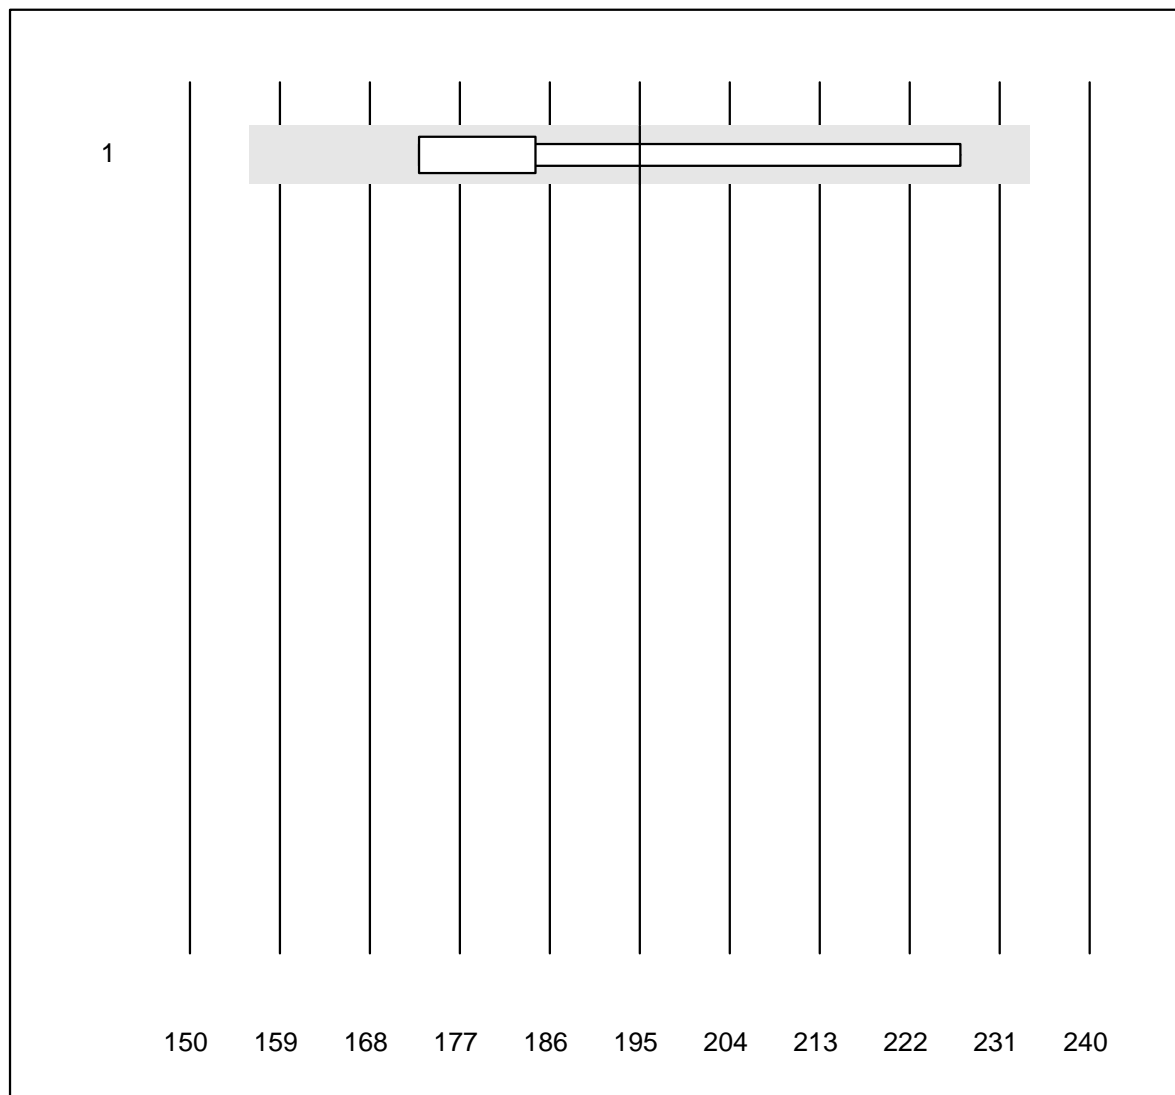


Tolérance MQ : 20 %

Anti-FIIa (Dabigatran) (µg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	195.00	12.4	a

Hémoglobine

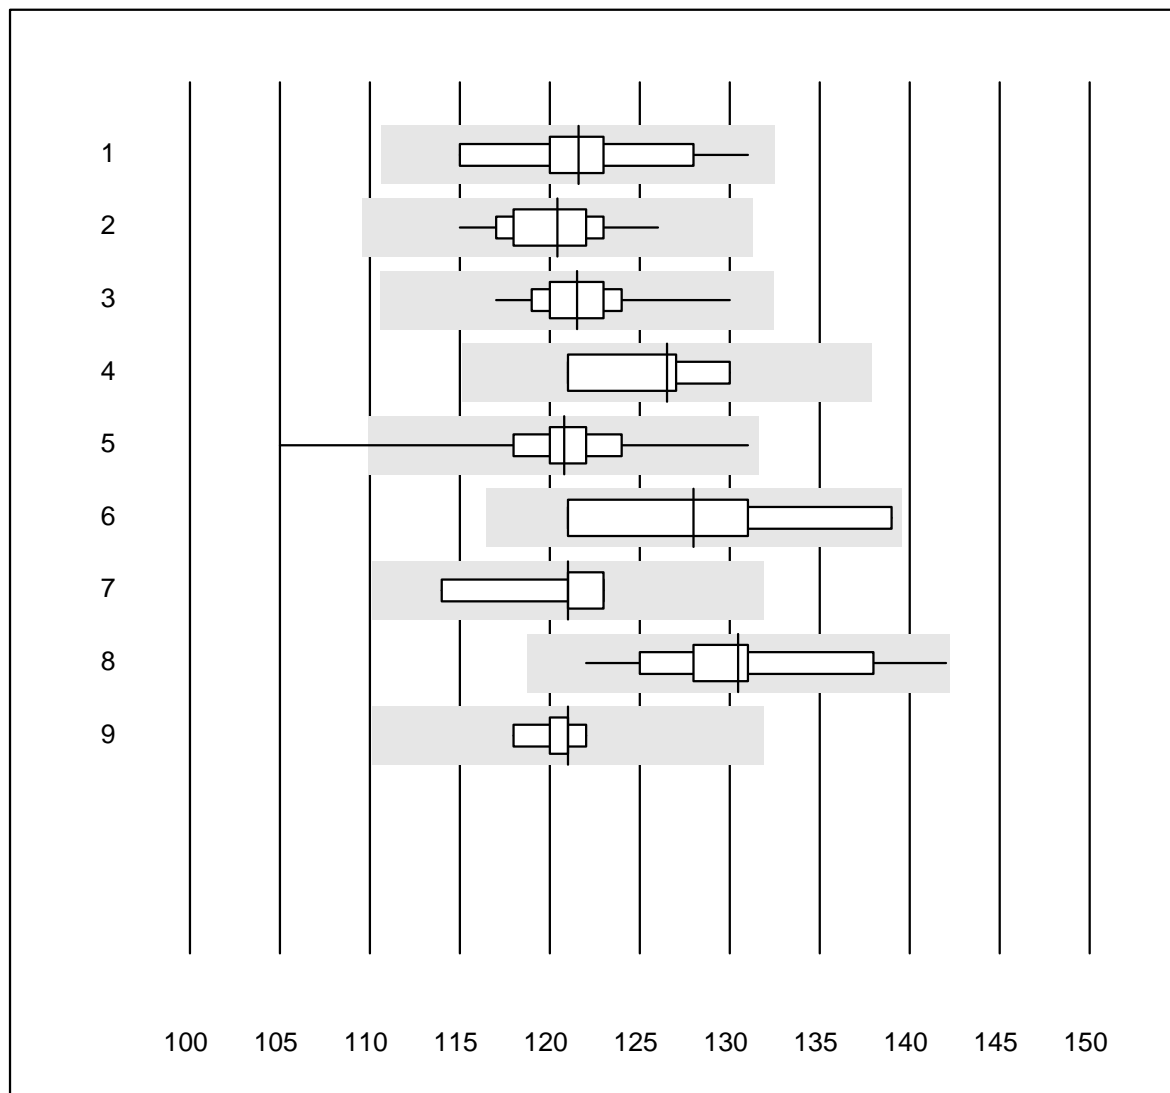


QUALAB Tolérance : 9 %

Hémoglobine (g/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Automate	17	100.0	0.0	0.0	121.6	3.4	e
2 Cyanmethémoglobine	23	95.7	0.0	4.3	120.4	2.3	e
3 Sysmex X	45	100.0	0.0	0.0	121.5	1.8	e
4 Advia 120	4	100.0	0.0	0.0	126.5	3.0	e*
5 Hemocue	408	96.1	1.0	2.9	120.8	2.5	e
6 Dr. Lange	4	100.0	0.0	0.0	128.0	6.1	e*
7 Hemocontrol	10	100.0	0.0	0.0	121.0	2.4	e
8 DiaSpect	16	93.7	0.0	6.3	130.5	3.8	e
9 Sysmex	8	100.0	0.0	0.0	121.0	1.0	e

Hémoglobine

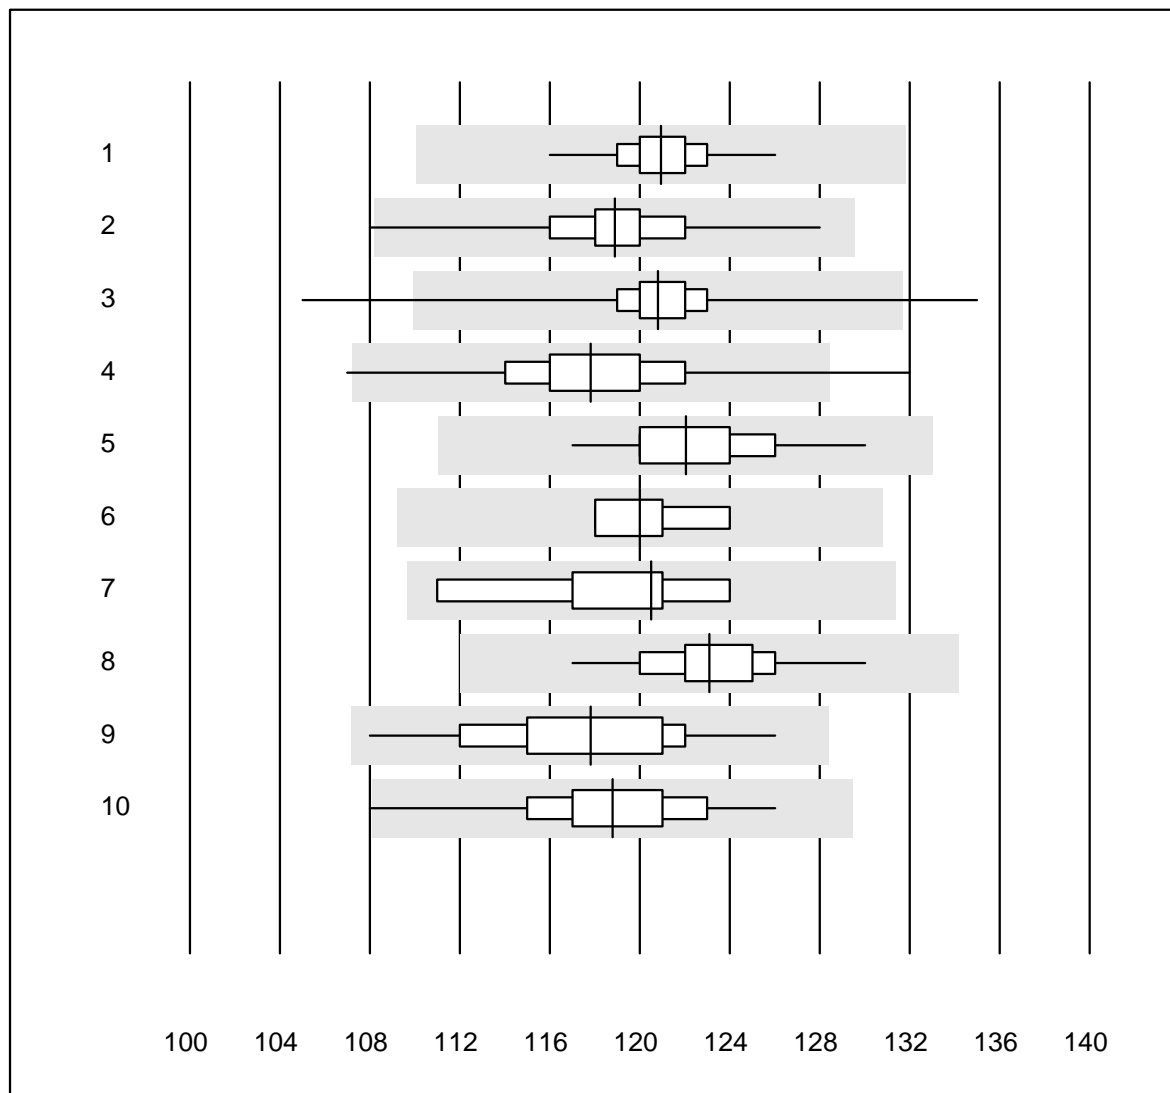


QUALAB Tolérance : 9 %

Hémoglobine (g/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1	Sysmex KX21	210	99.0	0.0	1.0	121.0	1.3	e
2	Sysmex PochH - 100i	202	98.5	0.5	1.0	118.9	2.2	e
3	Sysmex XP 300	596	98.0	0.8	1.2	120.8	1.7	e
4	Mythic	275	96.0	1.5	2.5	117.8	2.9	e
5	Swelab	33	100.0	0.0	0.0	122.1	2.2	e
6	Abacus Junior	5	80.0	0.0	20.0	120.0	2.1	e
7	Medonic	6	83.3	0.0	16.7	120.5	4.2	e*
8	Celltac Alpha (Nihon	88	97.7	0.0	2.3	123.1	2.0	e
9	Samsung HC10	27	96.3	0.0	3.7	117.8	3.6	e
10	Micros 60	131	96.9	0.8	2.3	118.8	2.5	e

Hématocrite

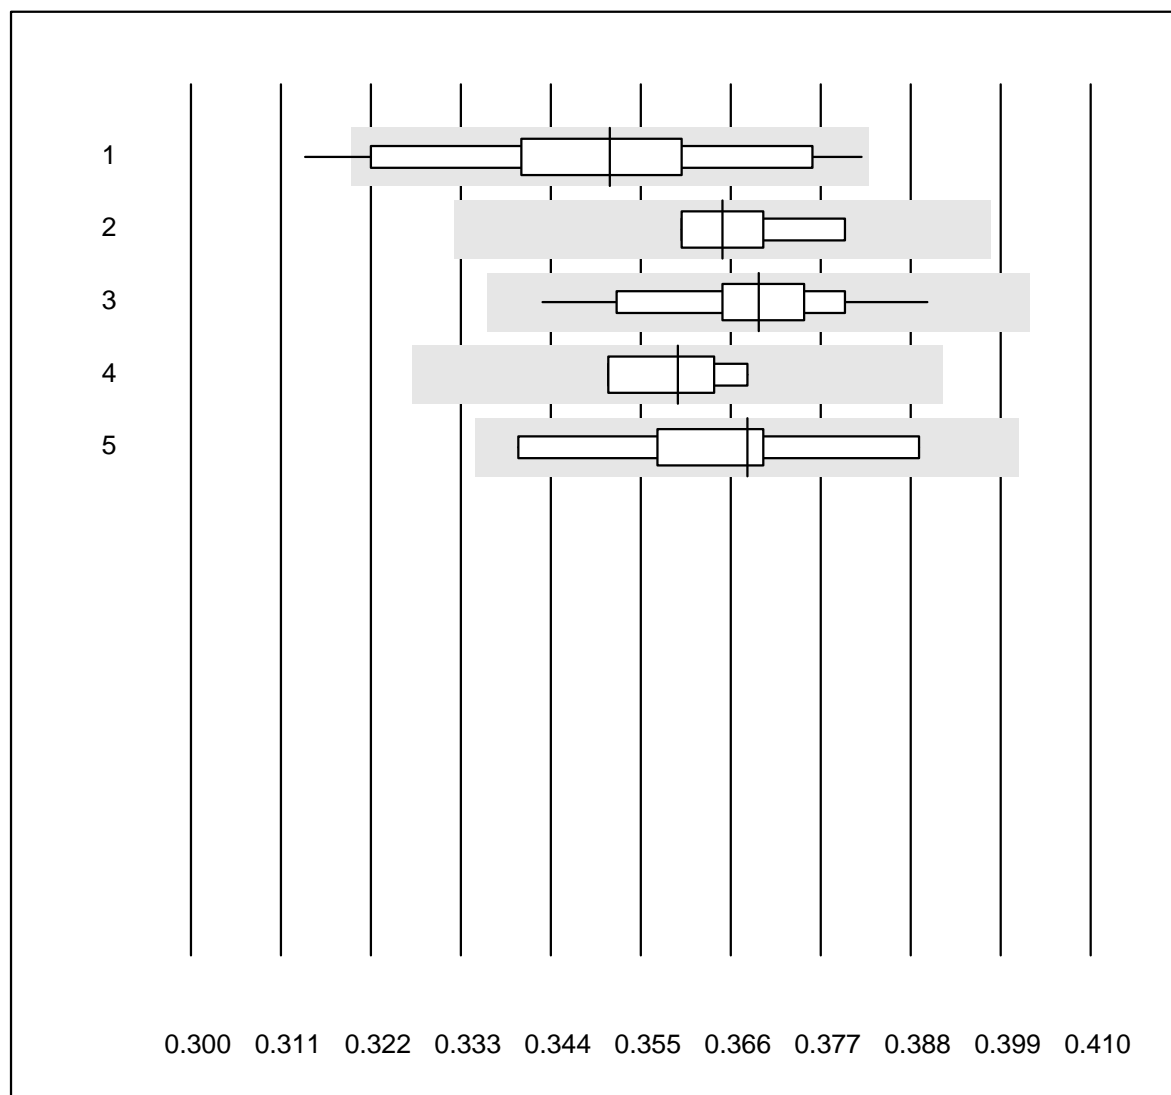


QUALAB Tolérance : 9 %

Hématocrite (l/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Automate	15	93.3	6.7	0.0	0.35	5.3	e*
2 Centrifuge	4	100.0	0.0	0.0	0.37	2.6	e*
3 Sysmex X	45	100.0	0.0	0.0	0.37	2.8	e
4 Advia 120	4	100.0	0.0	0.0	0.36	2.2	e*
5 Sysmex	8	100.0	0.0	0.0	0.37	3.9	e*

Hématocrite

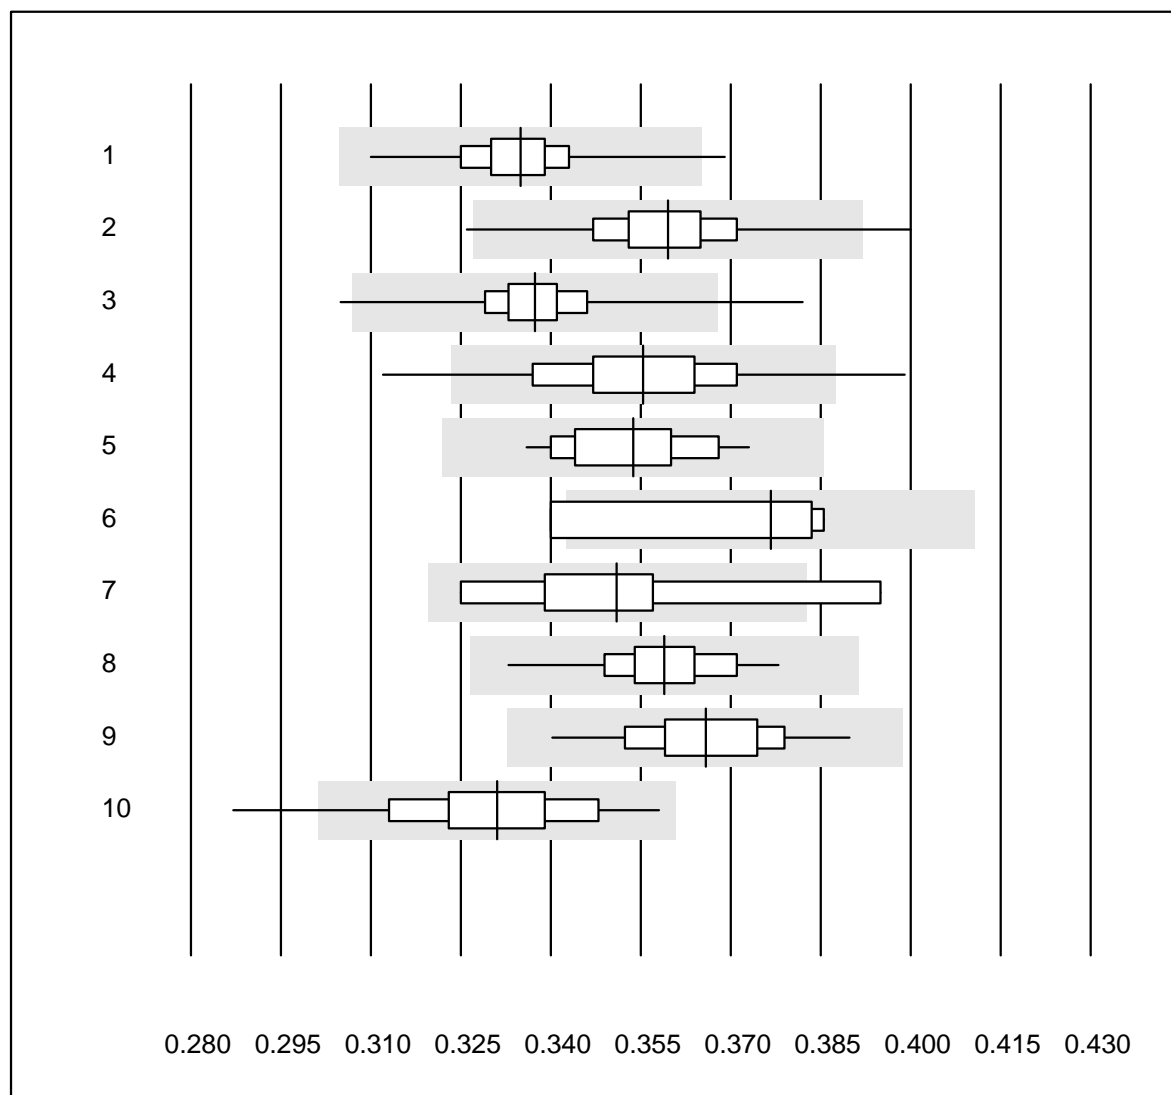


QUALAB Tolérance : 9 %

Hématocrite (l/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Sysmex KX21	210	98.1	0.5	1.4	0.34	2.3	e
2 Sysmex PochH - 100i	202	96.0	2.5	1.5	0.36	3.0	e
3 Sysmex XP 300	597	97.4	0.8	1.8	0.34	2.2	e
4 Mythic	275	96.0	2.2	1.8	0.36	3.8	e
5 Swelab	33	100.0	0.0	0.0	0.35	2.9	e
6 Abacus Junior	5	60.0	20.0	20.0	0.38	5.7	e*
7 Medonic	6	83.3	16.7	0.0	0.35	6.7	e*
8 Celltac Alpha (Nihon)	88	97.7	0.0	2.3	0.36	2.5	e
9 Samsung HC10	27	96.3	0.0	3.7	0.37	3.1	e
10 Micros 60	131	93.9	3.8	2.3	0.33	4.0	e

Erythrocytes

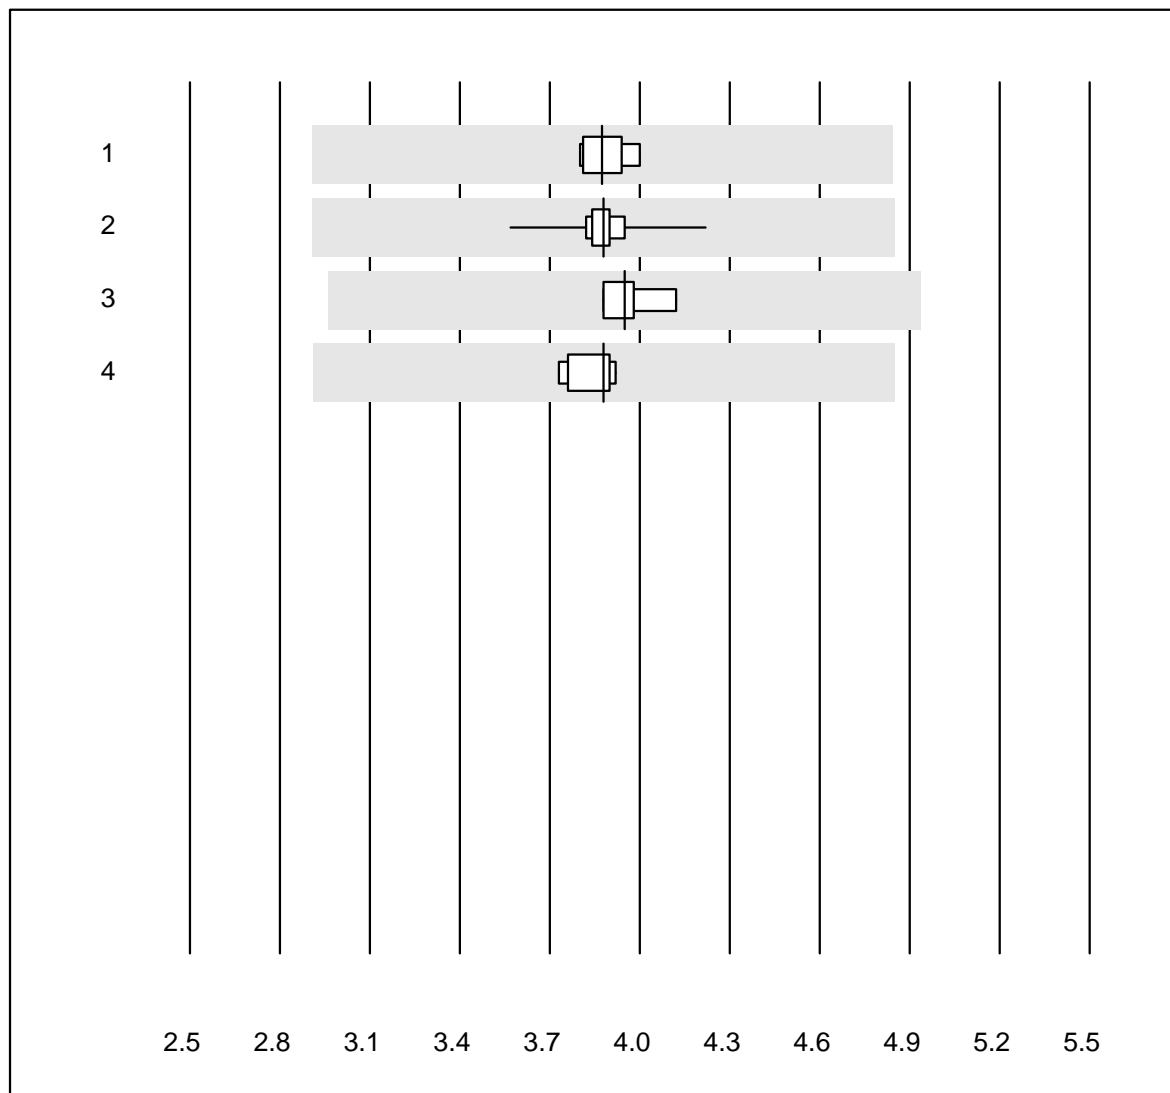


QUALAB Tolérance : 25 %

Erythrocytes (T/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Automate	14	100.0	0.0	0.0	3.87	1.9	e
2 Sysmex X	45	100.0	0.0	0.0	3.88	2.2	e
3 Advia 120	4	100.0	0.0	0.0	3.95	2.6	e
4 Sysmex	8	100.0	0.0	0.0	3.88	1.9	e

Erythrocytes

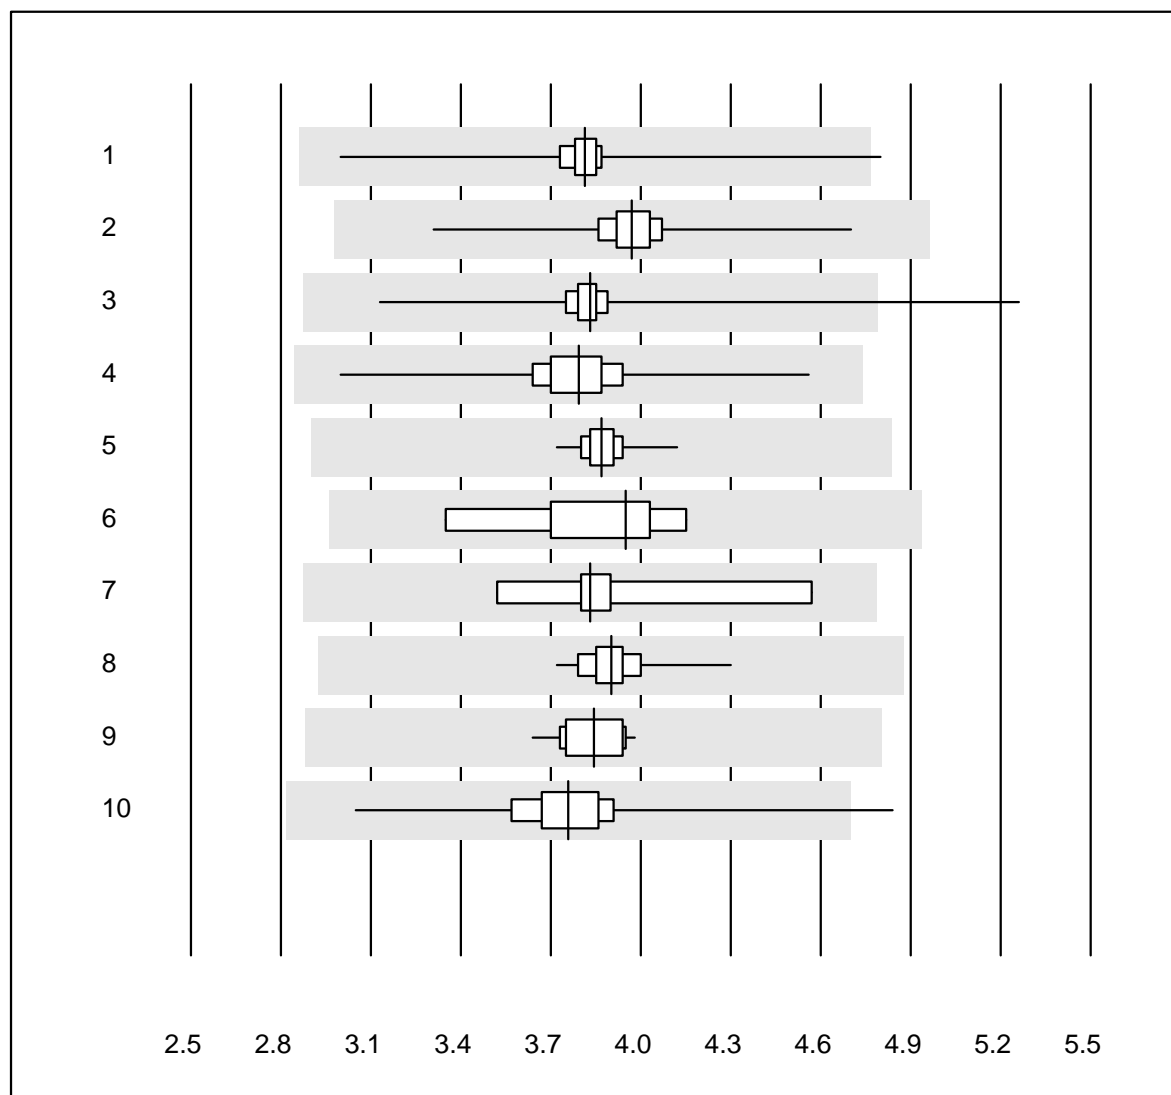


QUALAB Tolérance : 25 %

Erythrocytes (T/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1	Sysmex KX21	210	99.0	0.5	0.5	3.81	3.0	e
2	Sysmex PochH - 100i	202	100.0	0.0	0.0	3.97	3.3	e
3	Sysmex XP 300	597	99.0	0.8	0.2	3.83	3.9	e
4	Mythic	275	98.2	0.0	1.8	3.79	4.1	e
5	Swelab	33	100.0	0.0	0.0	3.87	1.9	e
6	Abacus Junior	5	100.0	0.0	0.0	3.95	8.3	e*
7	Medonic	6	100.0	0.0	0.0	3.83	9.0	e*
8	Celltac Alpha (Nihon	88	97.7	0.0	2.3	3.90	2.2	e
9	Samsung HC10	27	92.6	0.0	7.4	3.84	2.4	e
10	Micros 60	131	99.2	0.8	0.0	3.76	5.7	e

Leucocytes

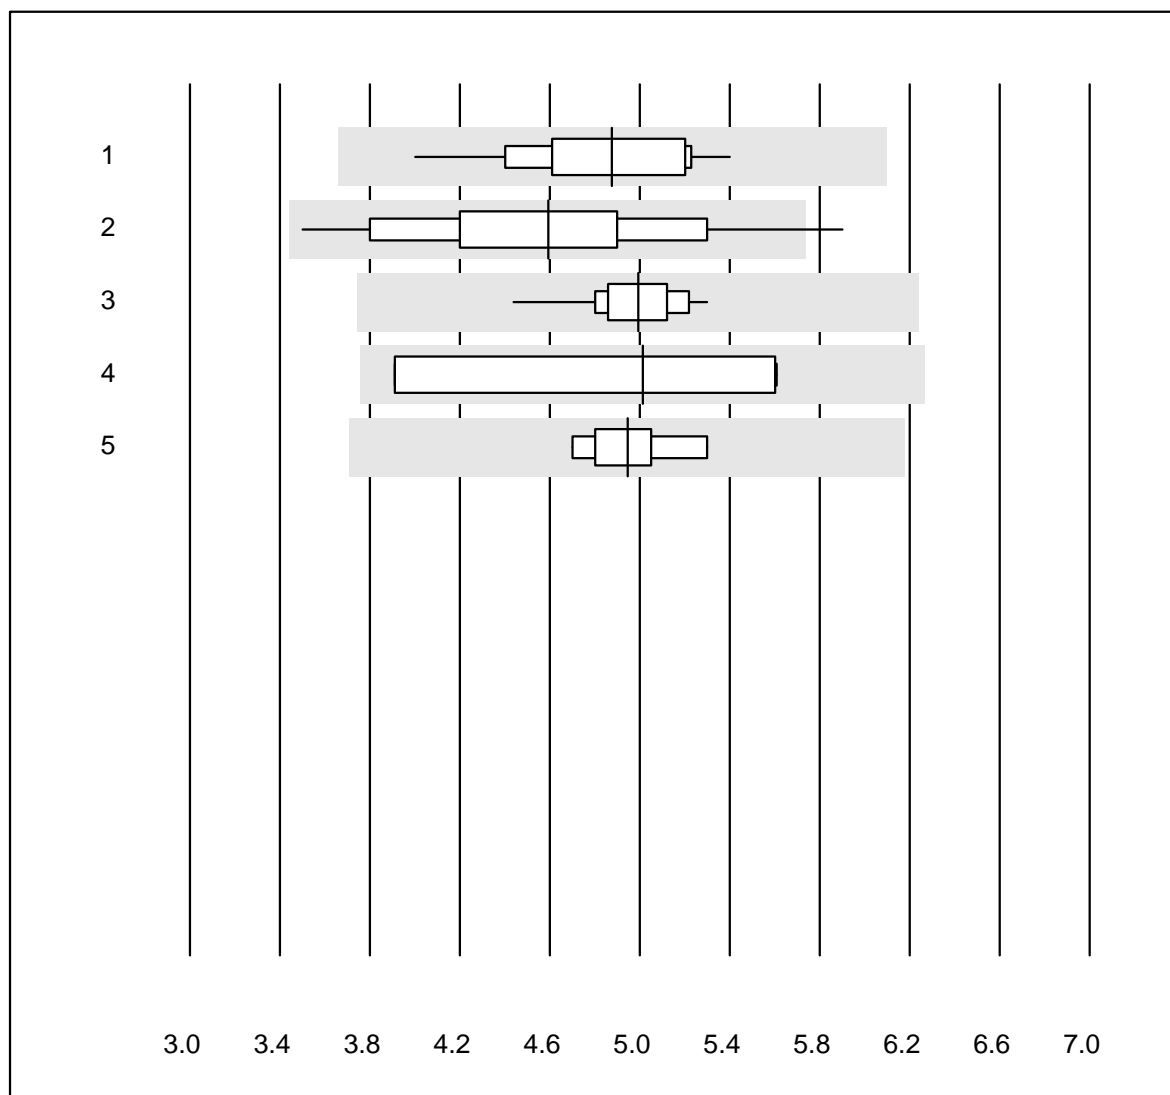


QUALAB Tolérance : 25 %

Leucocytes (G/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Automate	13	100.0	0.0	0.0	4.88	8.0	e
2 Microscopie	14	85.8	7.1	7.1	4.59	14.5	e*
3 Sysmex X	45	100.0	0.0	0.0	4.99	3.6	e
4 Advia 120 (Perox)	4	100.0	0.0	0.0	5.02	17.5	e*
5 Sysmex	8	100.0	0.0	0.0	4.95	3.9	e

Leucocytes

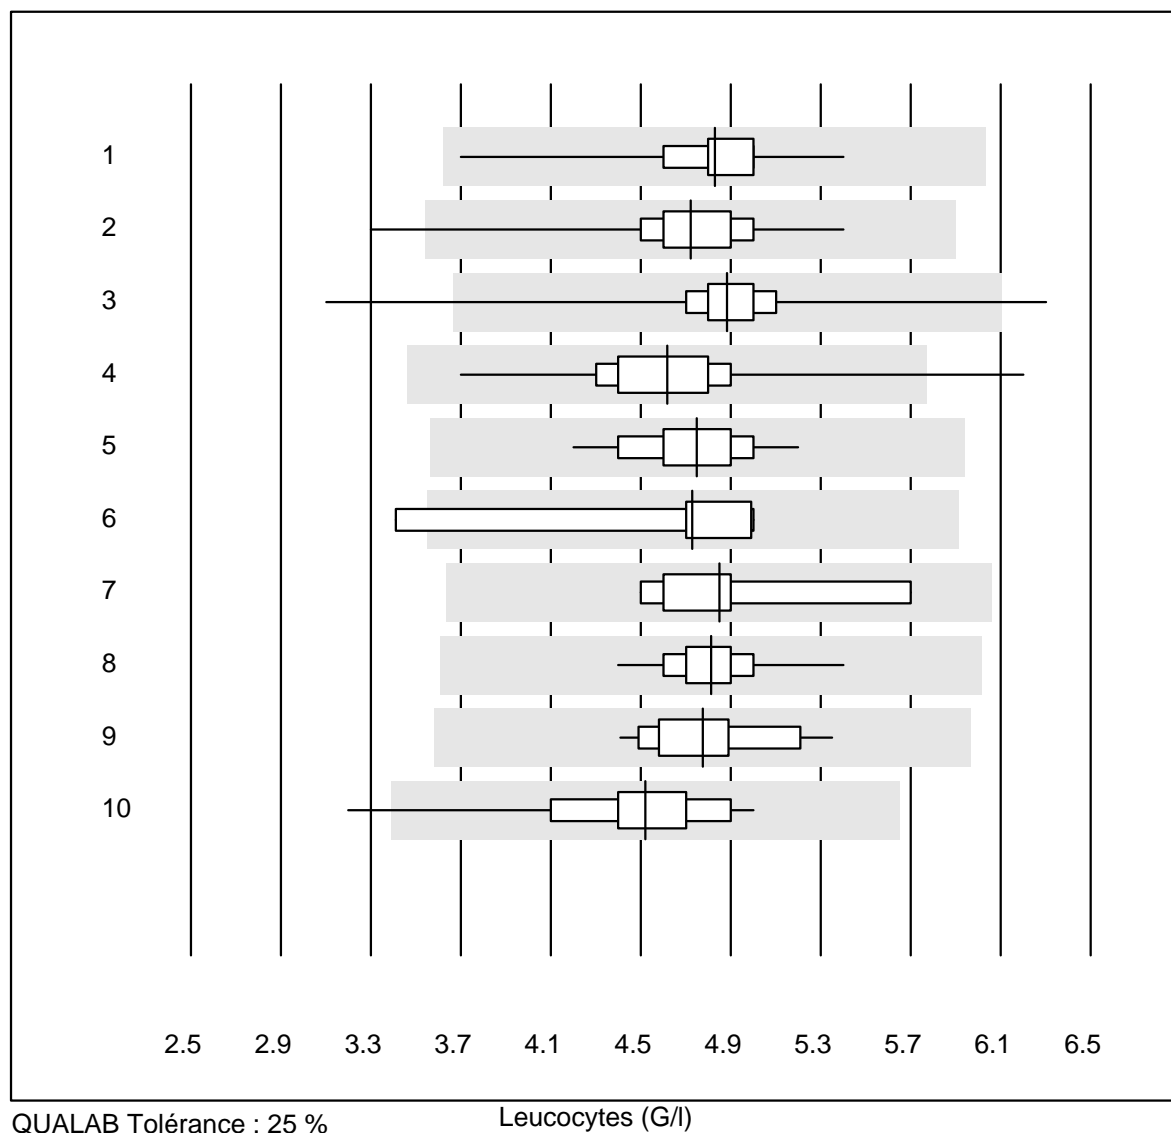

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1	Sysmex KX21	208	99.5	0.0	0.5	4.83	4.5	e
2	Sysmex PochH - 100i	202	99.5	0.5	0.0	4.72	5.2	e
3	Sysmex XP 300	597	99.4	0.3	0.3	4.88	4.8	e
4	Mythic	274	98.9	0.4	0.7	4.62	6.2	e
5	Swelab	33	97.0	0.0	3.0	4.75	4.9	e
6	Abacus Junior	5	80.0	20.0	0.0	4.73	14.5	e*
7	Medonic	6	100.0	0.0	0.0	4.85	8.7	e*
8	Celltac Alpha (Nihon	88	98.9	0.0	1.1	4.81	3.9	e
9	Samsung HC10	27	96.3	0.0	3.7	4.78	5.3	e
10	Micros 60	131	98.4	0.8	0.8	4.52	6.3	e

Thrombocytes

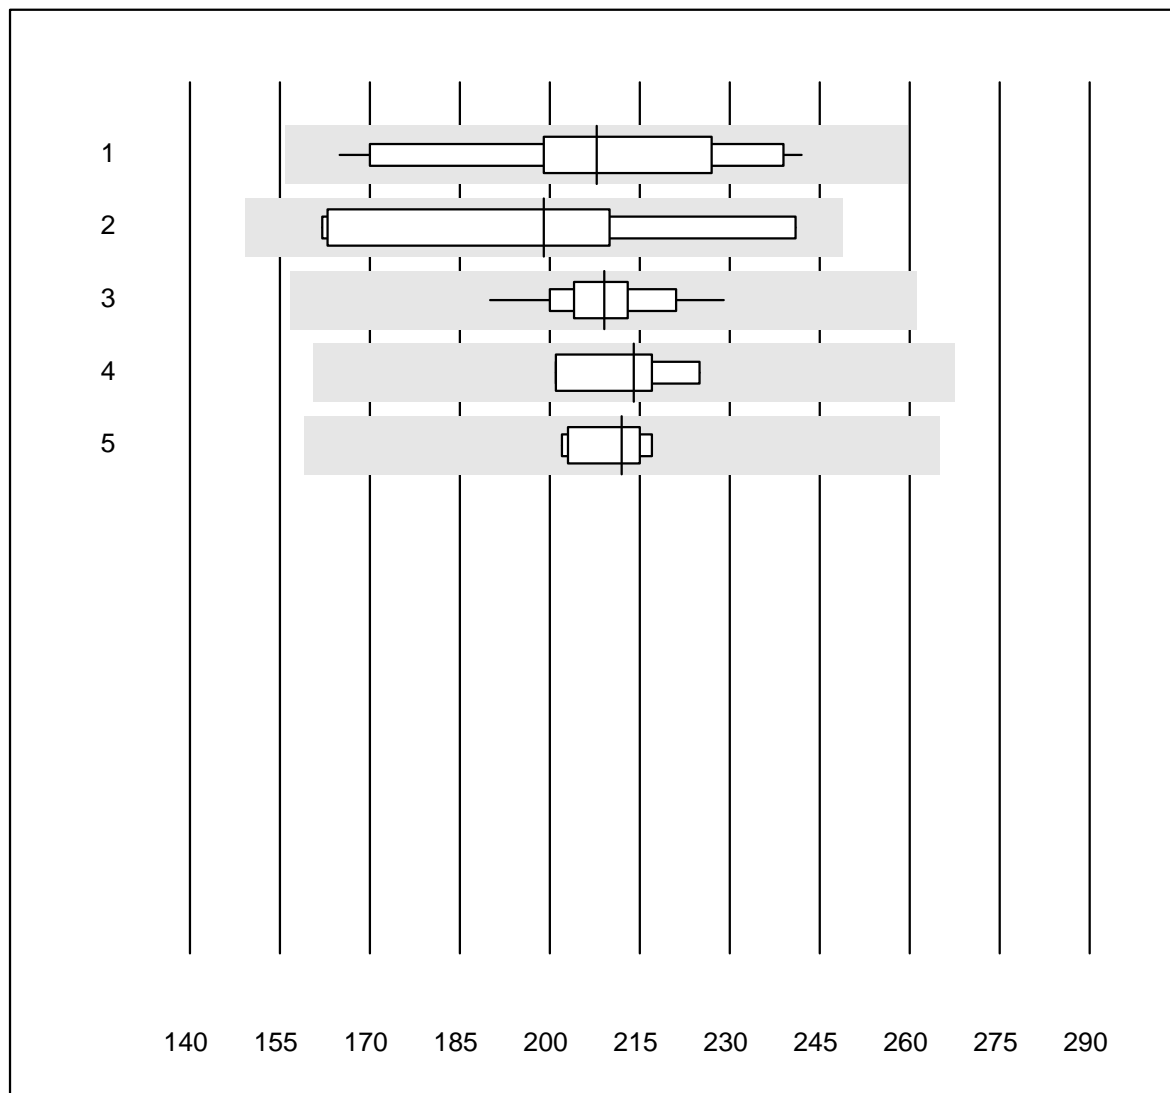


QUALAB Tolérance : 25 %

Thrombocytes (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Automate	13	100.0	0.0	0.0	207.8	11.6	e*
2 Microscopie	8	100.0	0.0	0.0	199.0	14.6	e*
3 Sysmex X	45	100.0	0.0	0.0	209.0	3.8	e
4 Advia 120	4	100.0	0.0	0.0	214.0	4.7	e
5 Sysmex	8	100.0	0.0	0.0	212.0	2.8	e

Thrombocytes

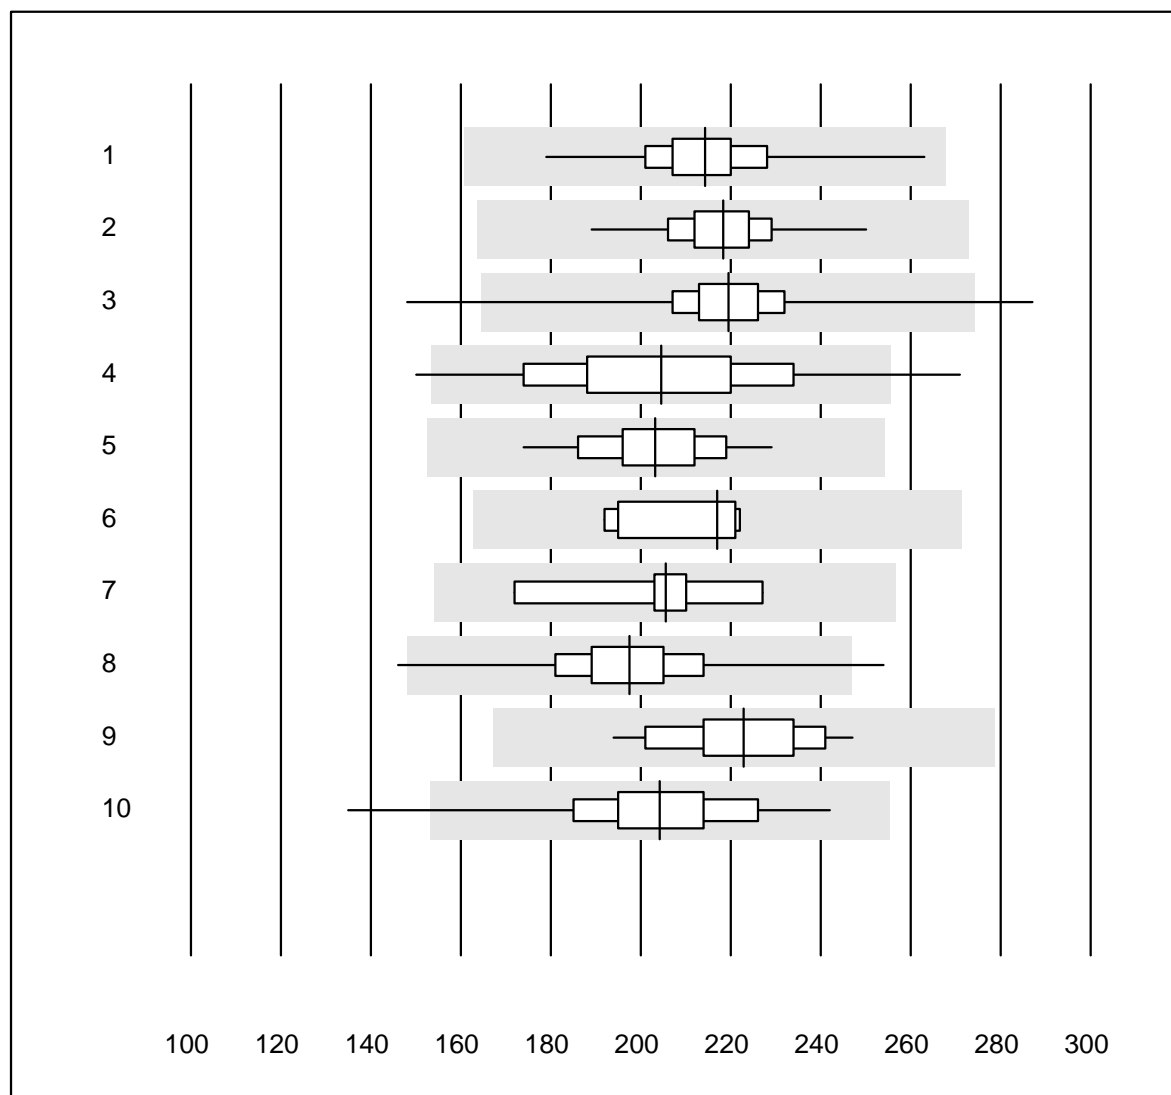


QUALAB Tolérance : 25 %

Thrombocytes (G/l)


No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1	Sysmex KX21	209	99.5	0.0	0.5	214.2	5.1	e
2	Sysmex PochH - 100i	201	100.0	0.0	0.0	218.3	4.5	e
3	Sysmex XP 300	595	99.3	0.5	0.2	219.4	4.9	e
4	Mythic	275	96.7	2.9	0.4	204.5	11.2	e
5	Swelab	33	100.0	0.0	0.0	203.3	6.2	e
6	Abacus Junior	5	100.0	0.0	0.0	217.0	7.0	e*
7	Medonic	6	100.0	0.0	0.0	205.5	8.8	e*
8	Celltac Alpha (Nihon	88	96.6	2.3	1.1	197.5	7.7	e
9	Samsung HC10	27	100.0	0.0	0.0	222.9	6.3	e
10	Micros 60	131	99.2	0.8	0.0	204.2	8.4	e

Hémoglobine H2

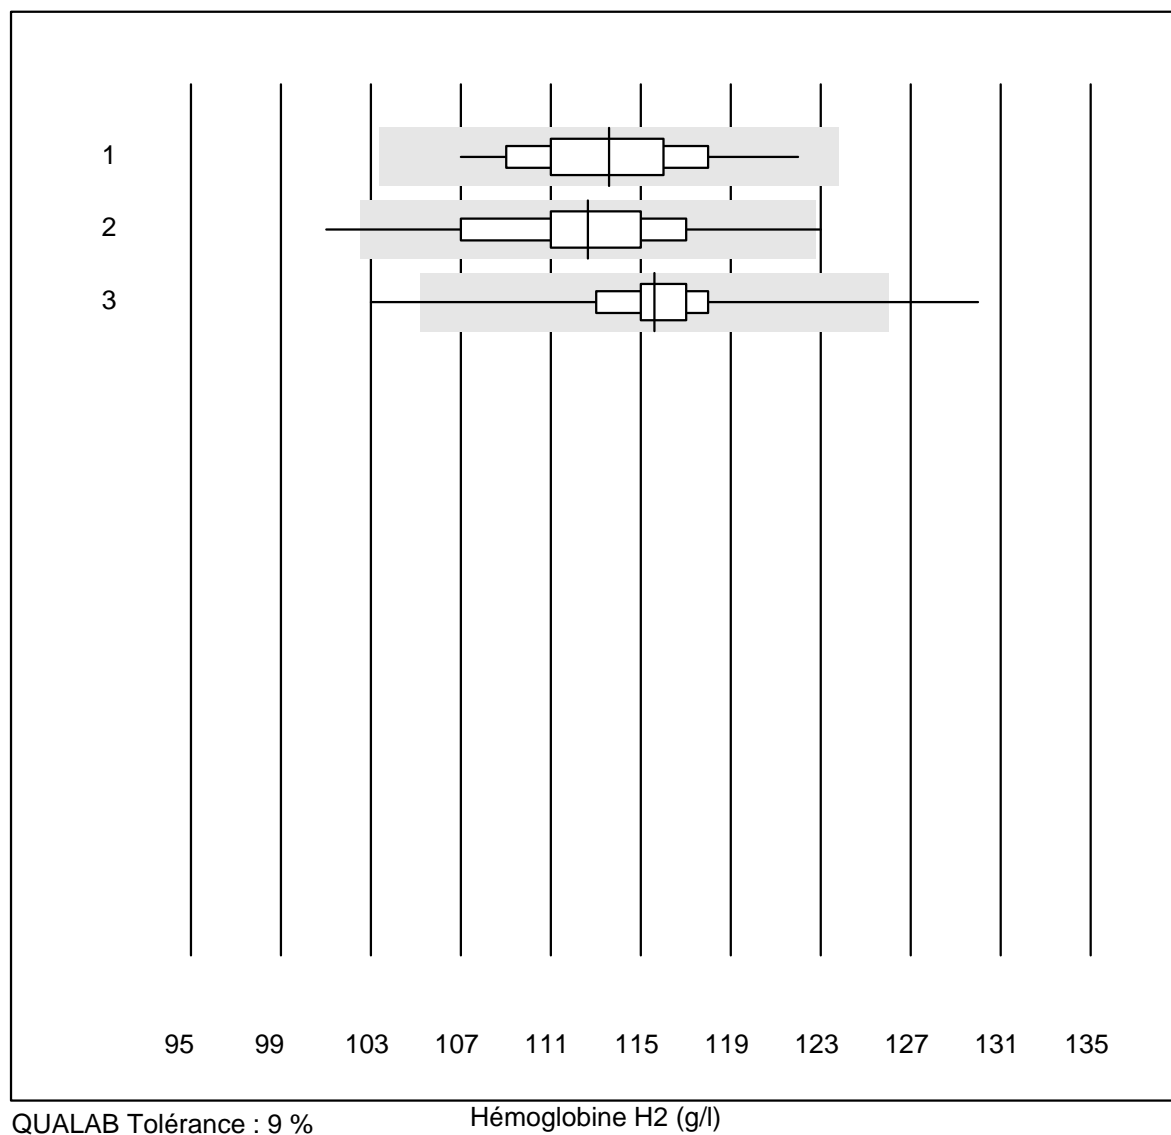

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Z3	94	94.7	0.0	5.3	113.6	2.9	e
2 Abx Micros	109	97.2	2.8	0.0	112.6	3.3	e
3 Microsemi	798	98.1	0.8	1.1	115.6	2.0	e

Hématocrite H2

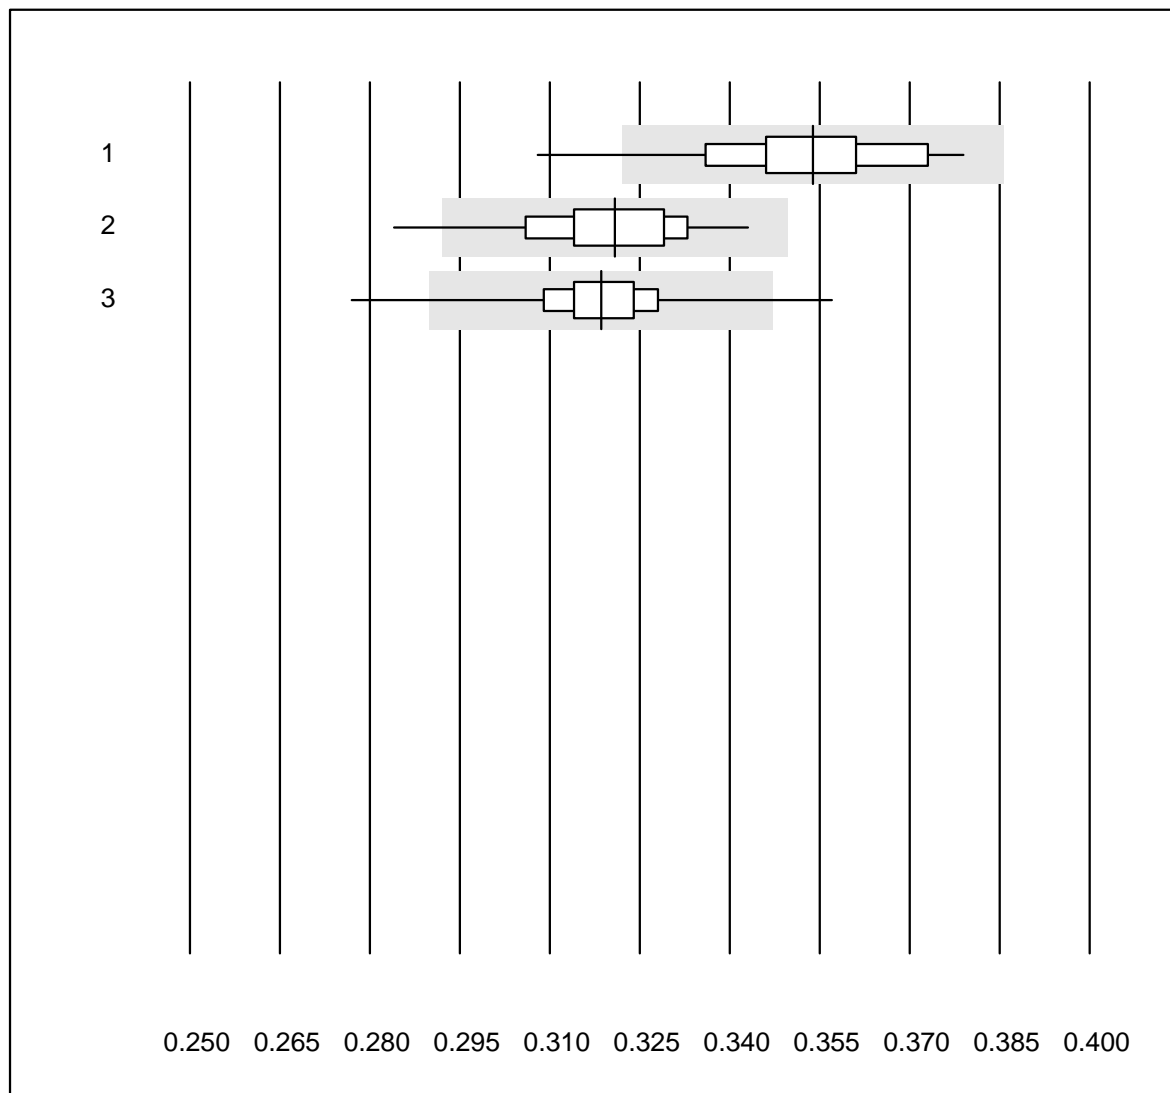


QUALAB Tolérance : 9 %

Hématocrite H2 (l/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Z3	94	91.5	3.2	5.3	0.35	3.9	e
2 Abx Micros	109	96.4	1.8	1.8	0.32	3.6	e
3 Microsemi	798	97.4	1.3	1.3	0.32	2.7	e

Leucocytes H2

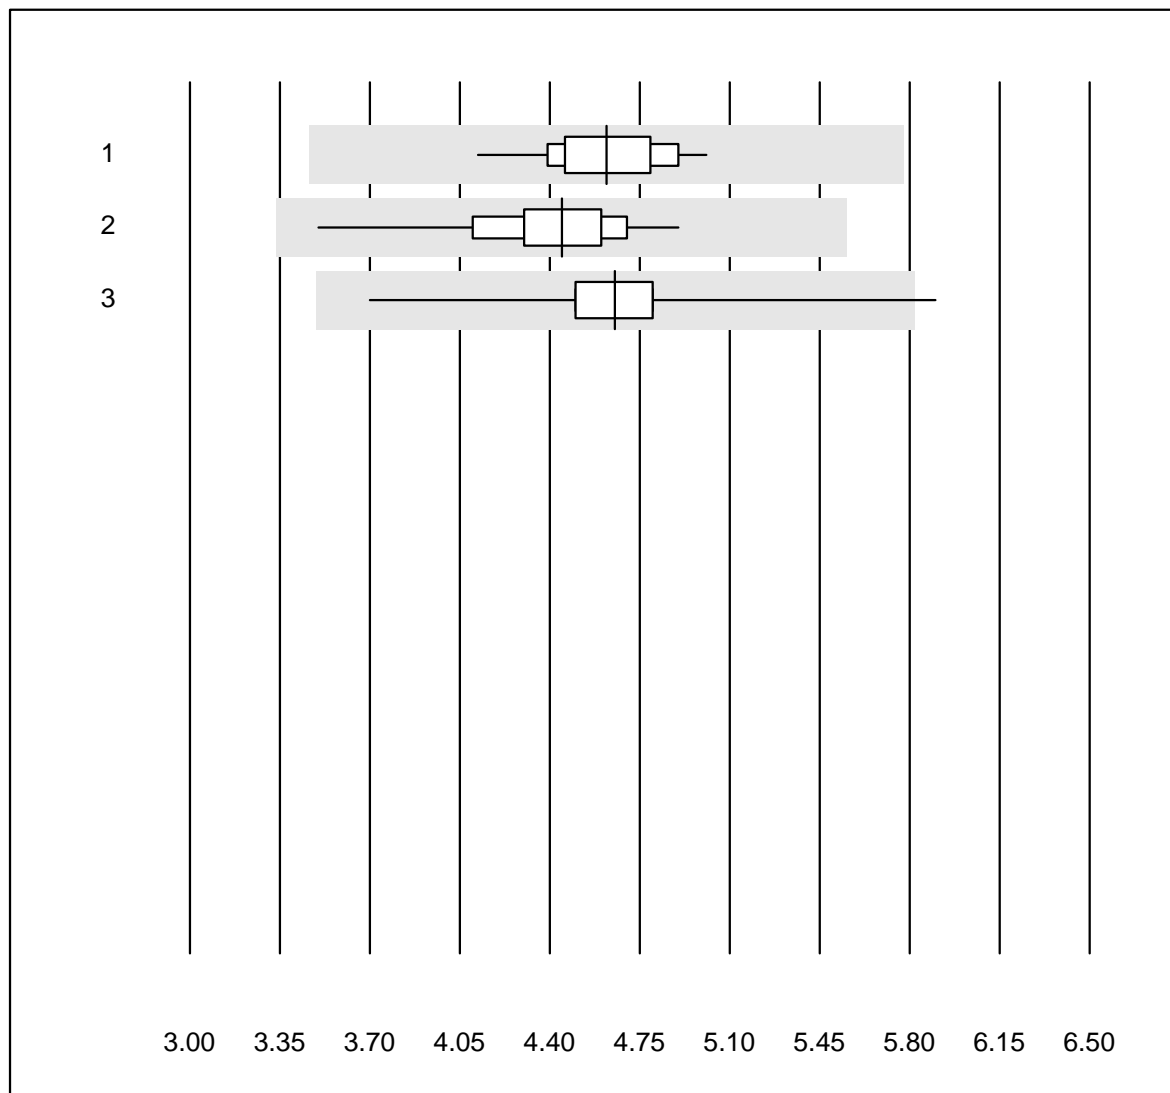


QUALAB Tolérance : 25 %

Leucocytes H2 (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Z3	94	100.0	0.0	0.0	4.62	4.4	e
2 Abx Micros	109	98.2	0.0	1.8	4.45	5.1	e
3 Microsemi	798	99.6	0.1	0.3	4.65	3.8	e

Thrombocytes H2

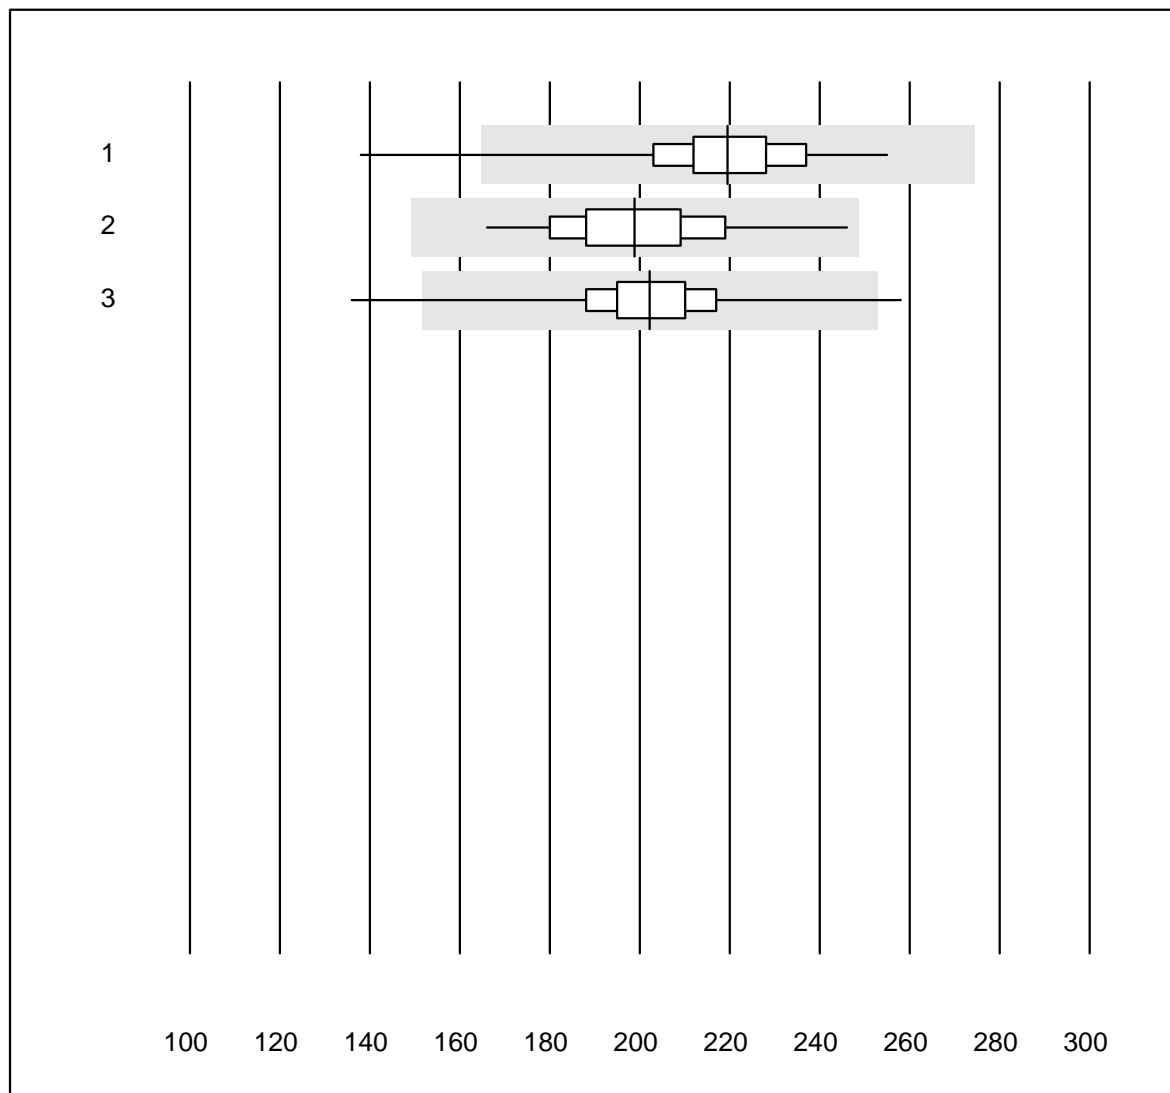


QUALAB Tolérance : 25 %

Thrombocytes H2 (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Z3	94	98.9	1.1	0.0	219.6	7.3	e
2 Abx Micros	109	100.0	0.0	0.0	198.8	7.8	e
3 Microsemi	797	99.0	0.9	0.1	202.2	6.6	e

Erythrocytes H2

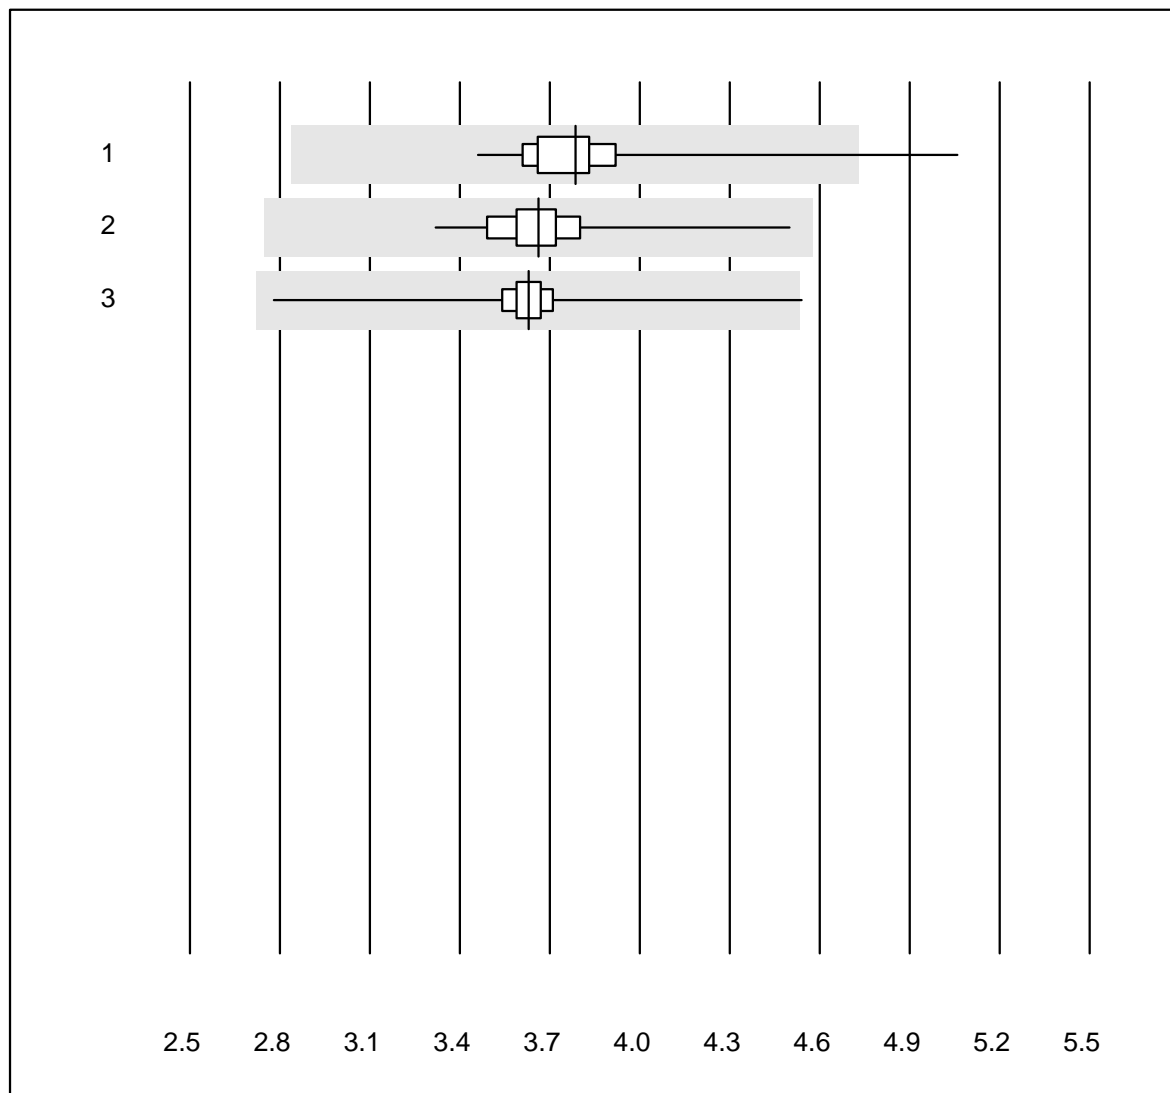


QUALAB Tolérance : 25 %

Erythrocytes H2 (T/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Z3	94	96.8	2.1	1.1	3.78	6.2	e
2 Abx Micros	109	100.0	0.0	0.0	3.66	3.9	e
3 Microsemi	798	99.8	0.1	0.1	3.63	2.7	e

CRP H2

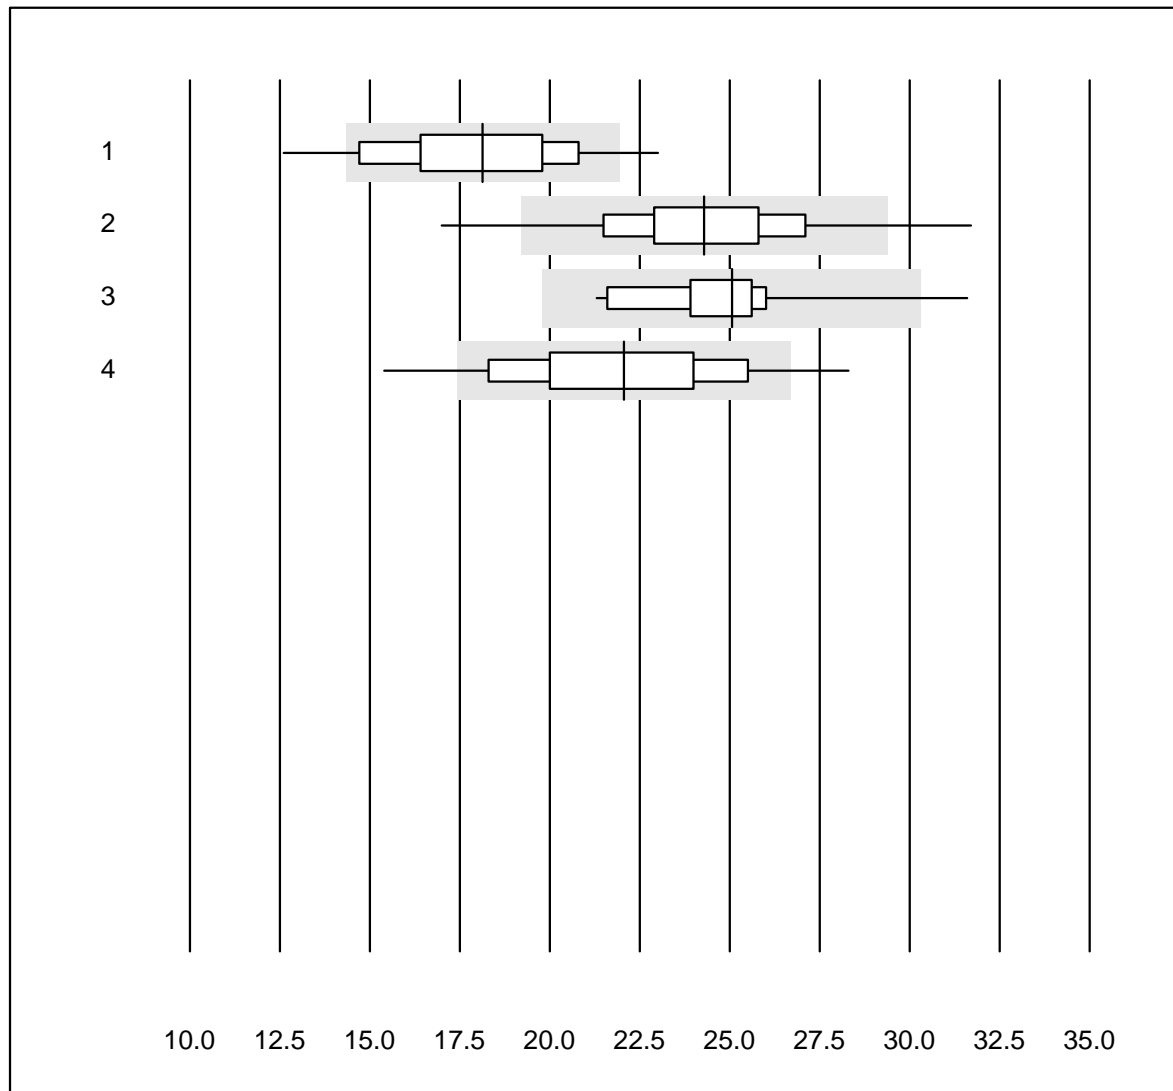

QUALAB Tolérance : 21 %

CRP H2 (mg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Z3	84	86.9	8.3	4.8	18.1	12.9	e
2 Microsemi	787	95.7	2.5	1.8	24.3	9.4	e
3 Abx Micros	15	86.6	6.7	6.7	25.1	9.5	e
4 ABX Micros CRP200	93	88.1	9.7	2.2	22.1	12.7	e

Hémoglobine BG




QUALAB Tolérance : 9 %

Hémoglobine BG (g/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 iStat	13	100.0	0.0	0.0	190.3	3.0	e

Hématocrite

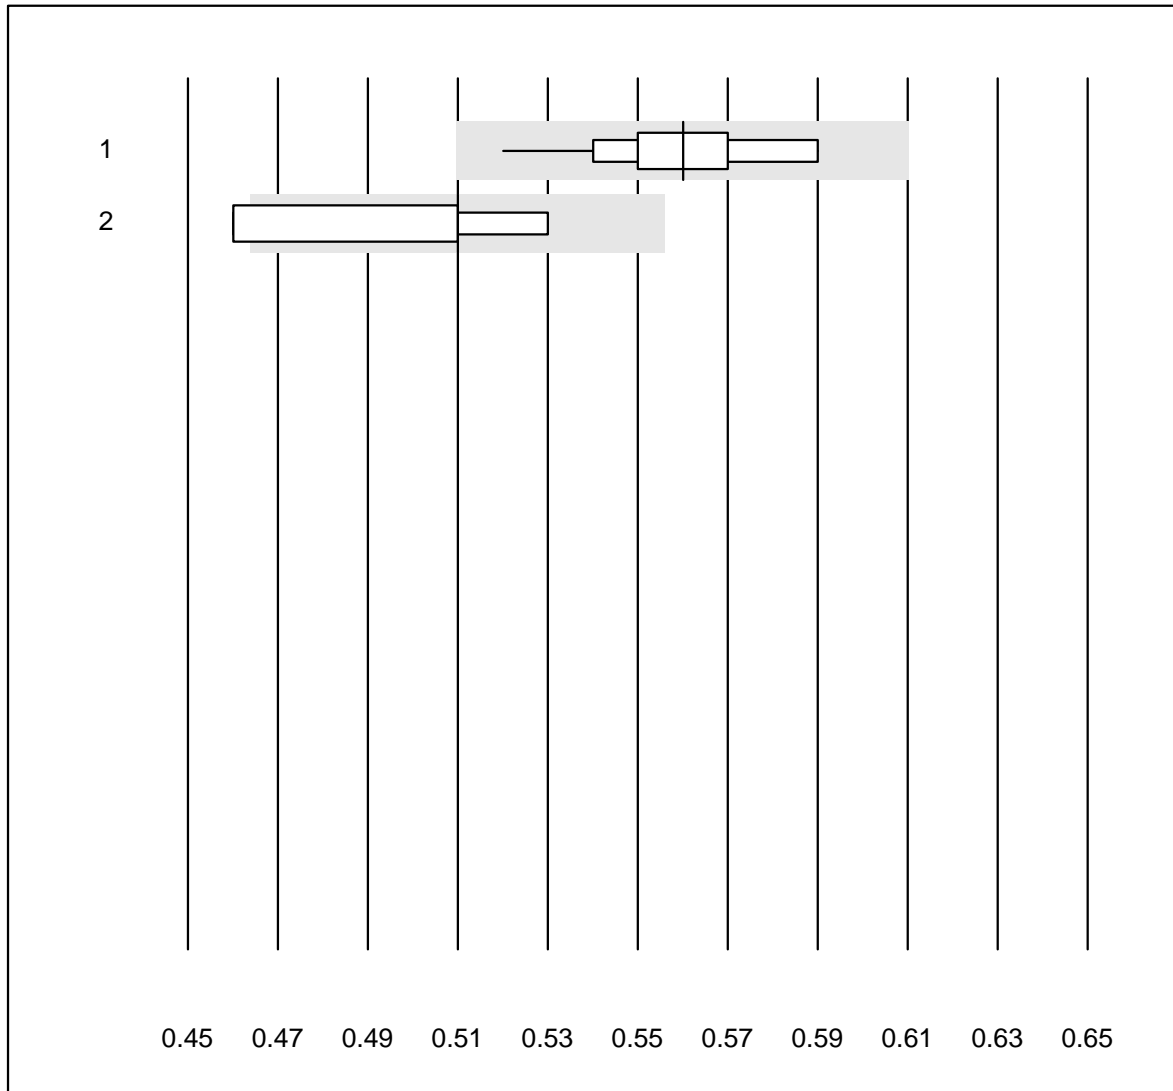


QUALAB Tolérance : 9 %

Hématocrite (l/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 iStat	19	100.0	0.0	0.0	0.56	3.1	e
2 EPOC	6	66.7	33.3	0.0	0.51	5.9	e*

Hémoglobine

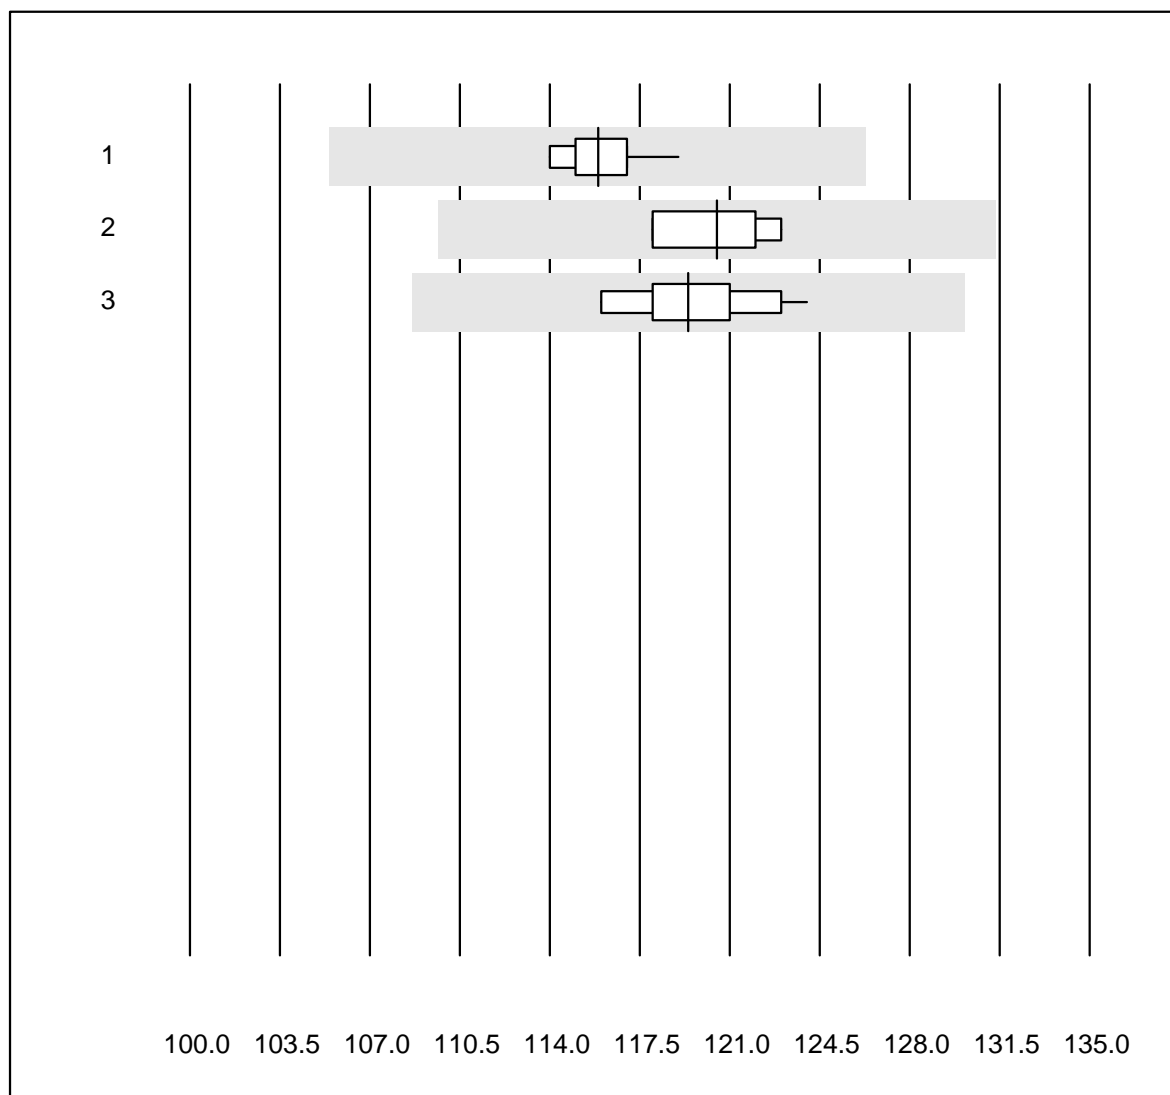


QUALAB Tolérance : 9 %

Hémoglobine (g/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Sysmex	76	100.0	0.0	0.0	115.9	1.1	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	120.5	2.0	e
3 Yumizen/Pentra	18	100.0	0.0	0.0	119.4	1.9	e

Hématocrite

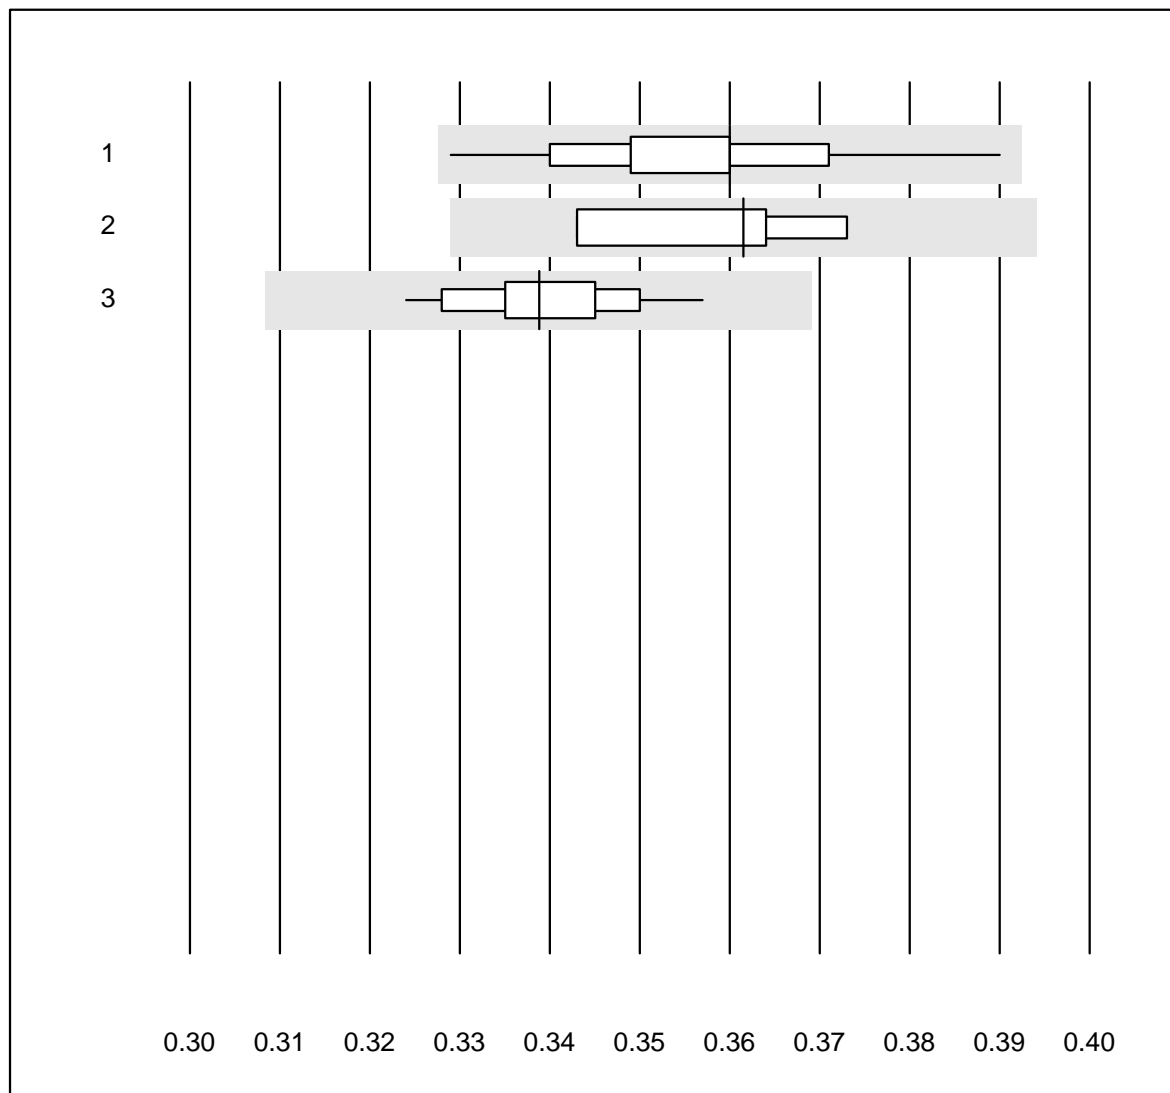


QUALAB Tolérance : 9 %

Hématocrite (l/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Sysmex	75	96.0	0.0	4.0	0.36	3.6	a
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	0.36	3.5	e*
3 Yumizen/Pentra	18	100.0	0.0	0.0	0.34	2.3	e

Erythrocytes

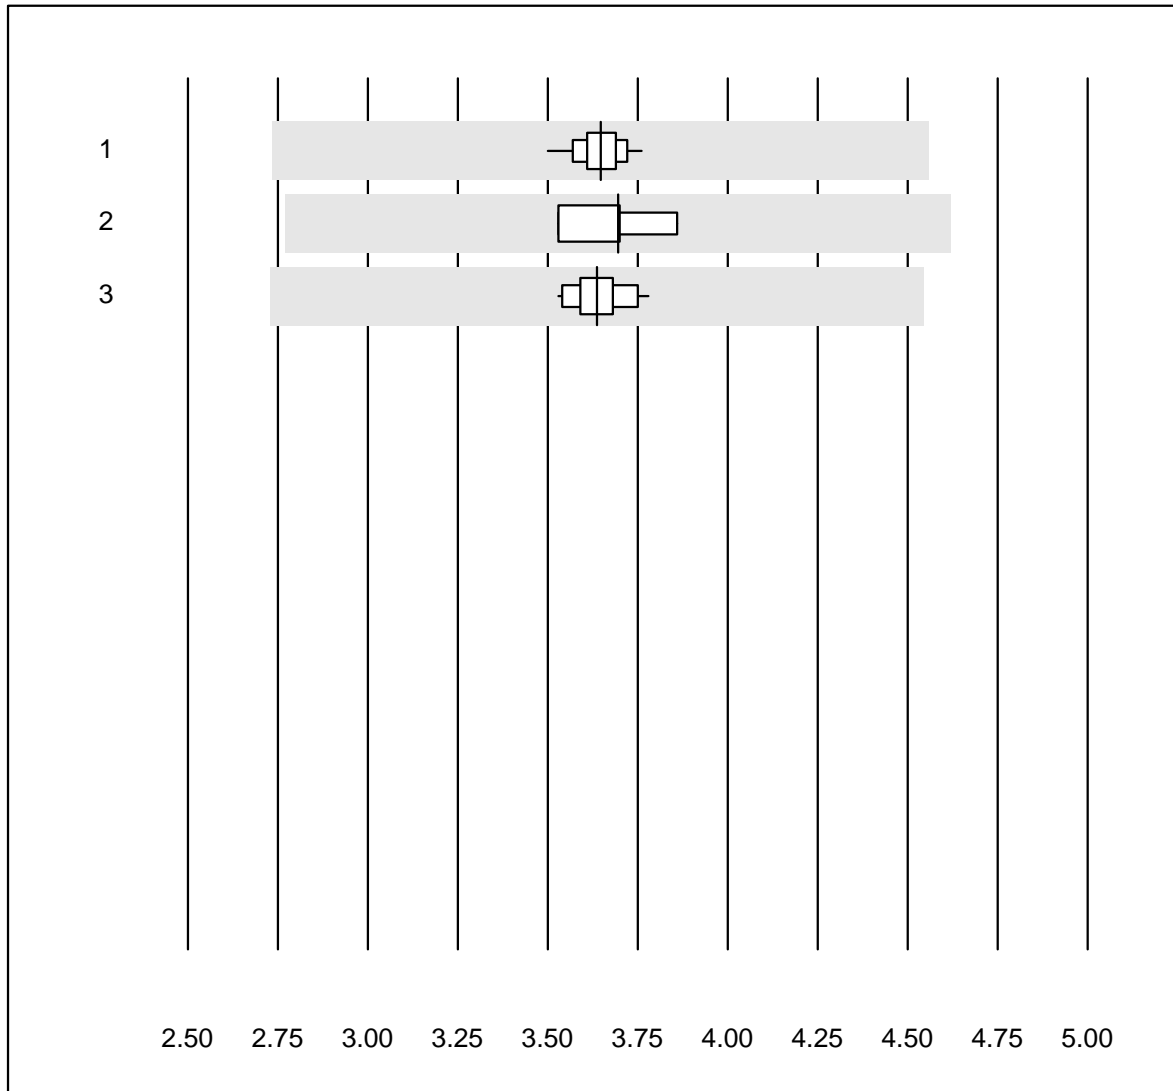


QUALAB Tolérance : 25 %

Erythrocytes (T/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Sysmex	76	100.0	0.0	0.0	3.65	1.5	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	3.70	3.6	e
3 Yumizen/Pentra	18	100.0	0.0	0.0	3.64	1.9	e

Leucocytes

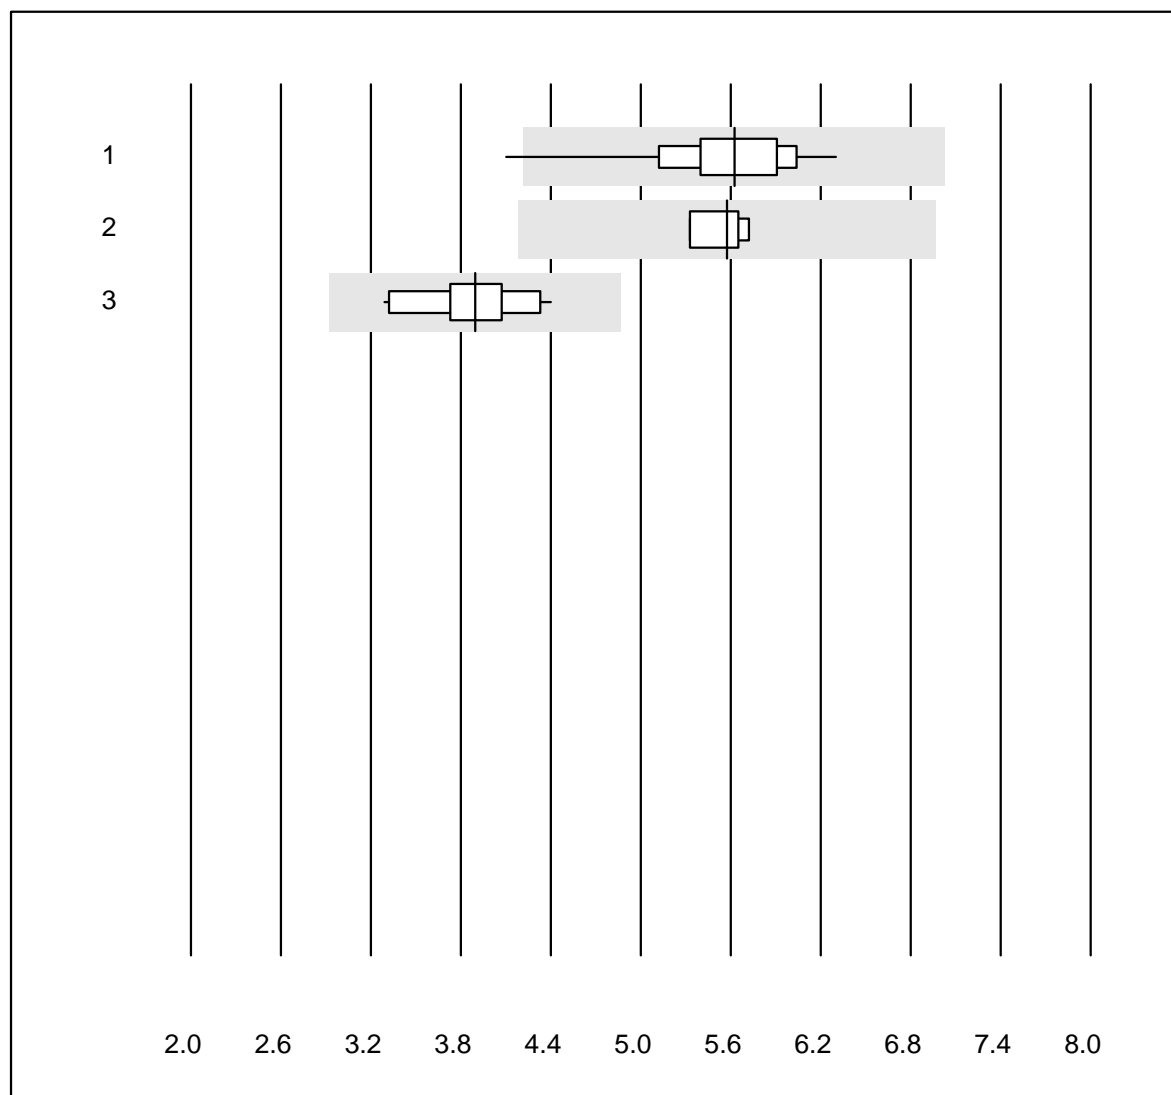


QUALAB Tolérance : 25 %

Leucocytes (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Sysmex	75	98.7	1.3	0.0	5.62	7.2	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	5.58	3.1	e
3 Yumizen/Pentra	16	87.5	0.0	12.5	3.89	9.3	e

Thrombocytes

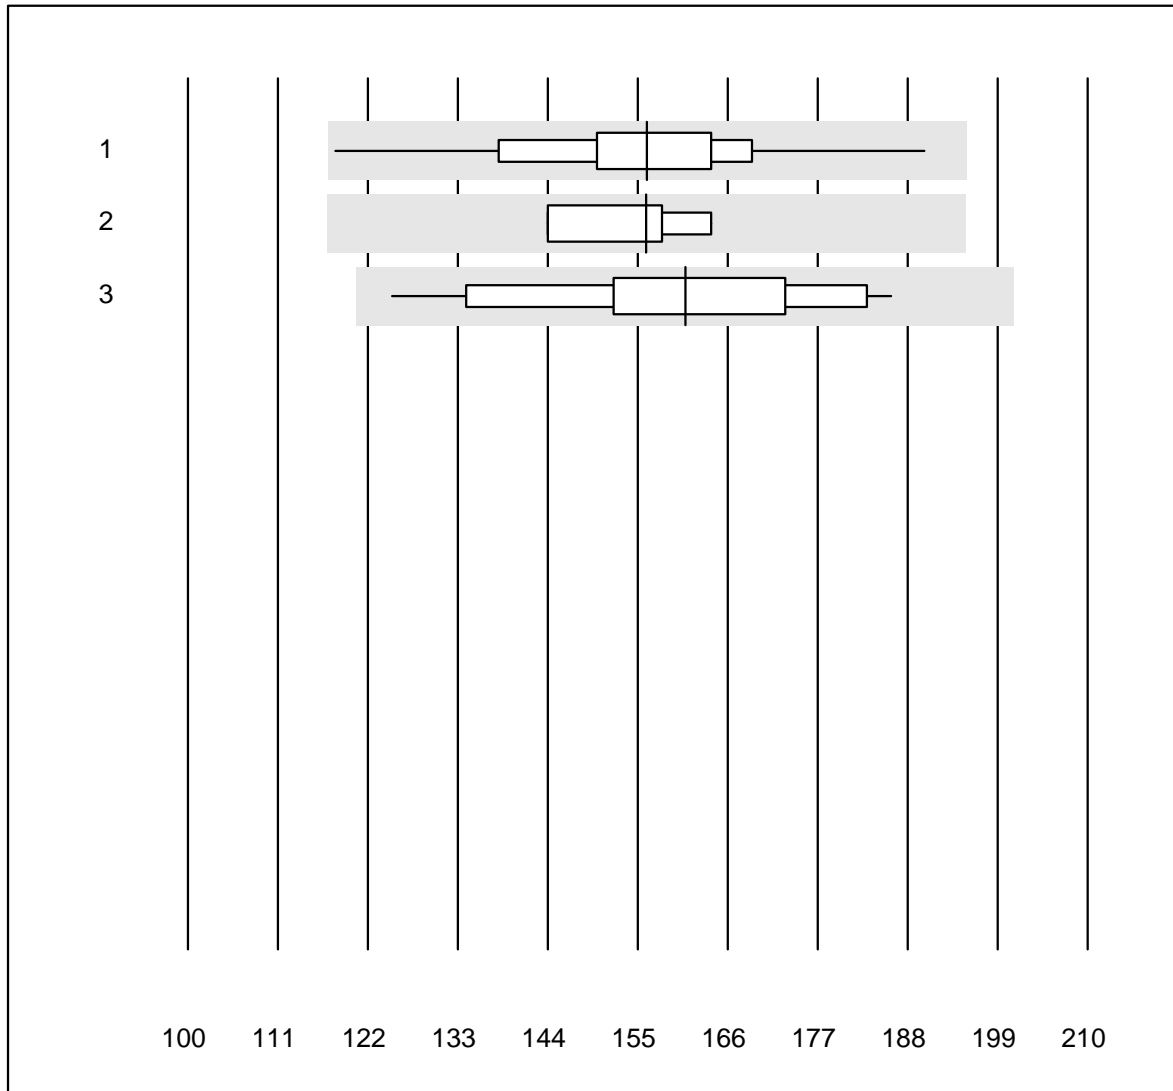


QUALAB Tolérance : 25 %

Thrombocytes (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Sysmex	76	100.0	0.0	0.0	156.1	8.2	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	156.0	5.4	e
3 Yumizen/Pentra	18	100.0	0.0	0.0	160.8	11.1	e

Neutrophiles

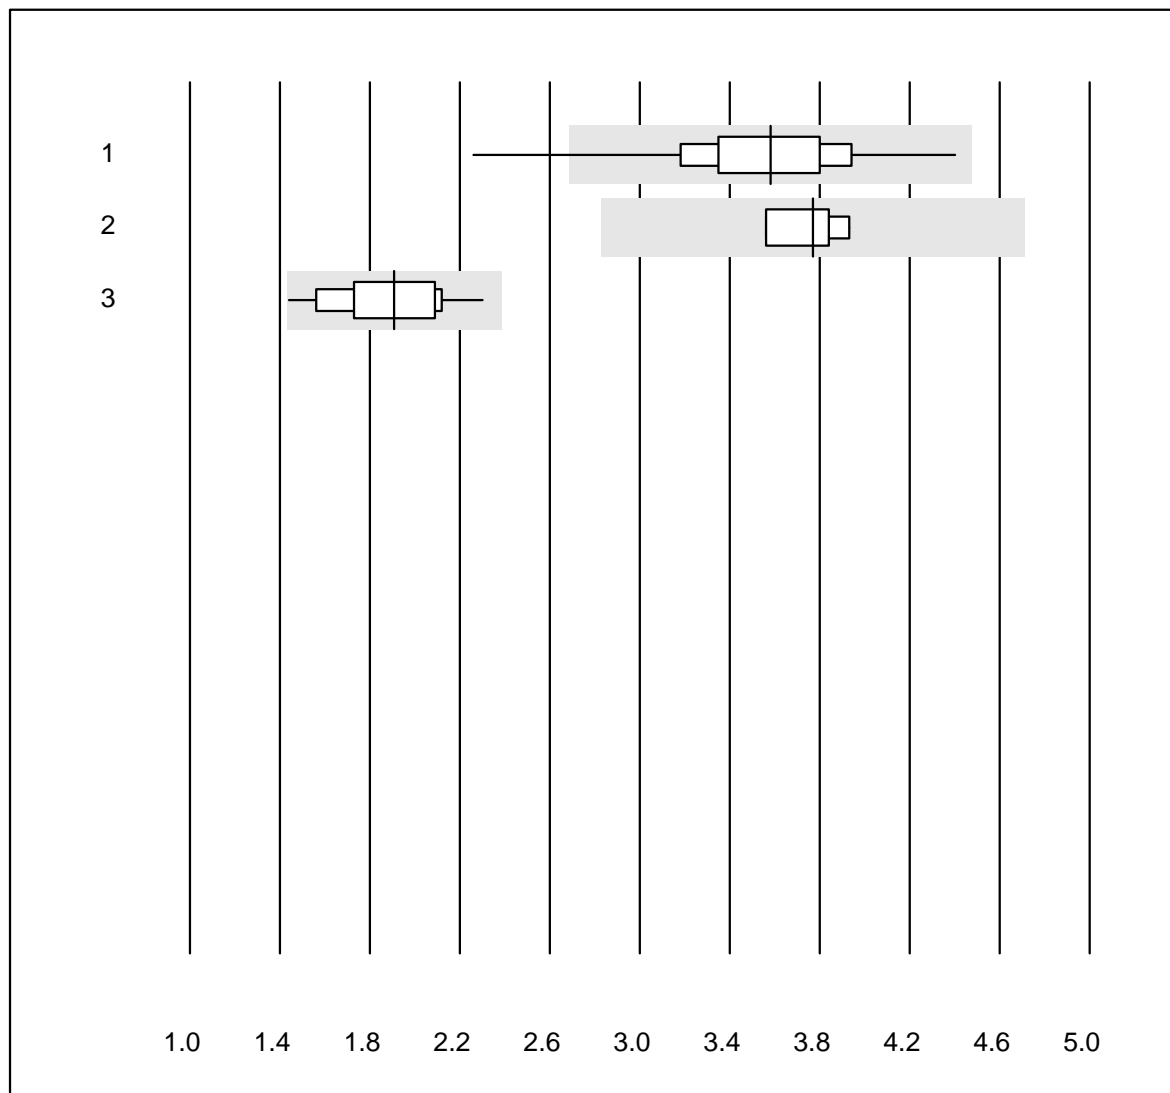


Tolérance MQ : 25 %

Neutrophiles (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Sysmex	76	97.4	2.6	0.0	3.58	10.0	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	3.77	4.3	e
3 Yumizen/Pentra	15	80.0	0.0	20.0	1.91	13.1	e*

Lymphocytes

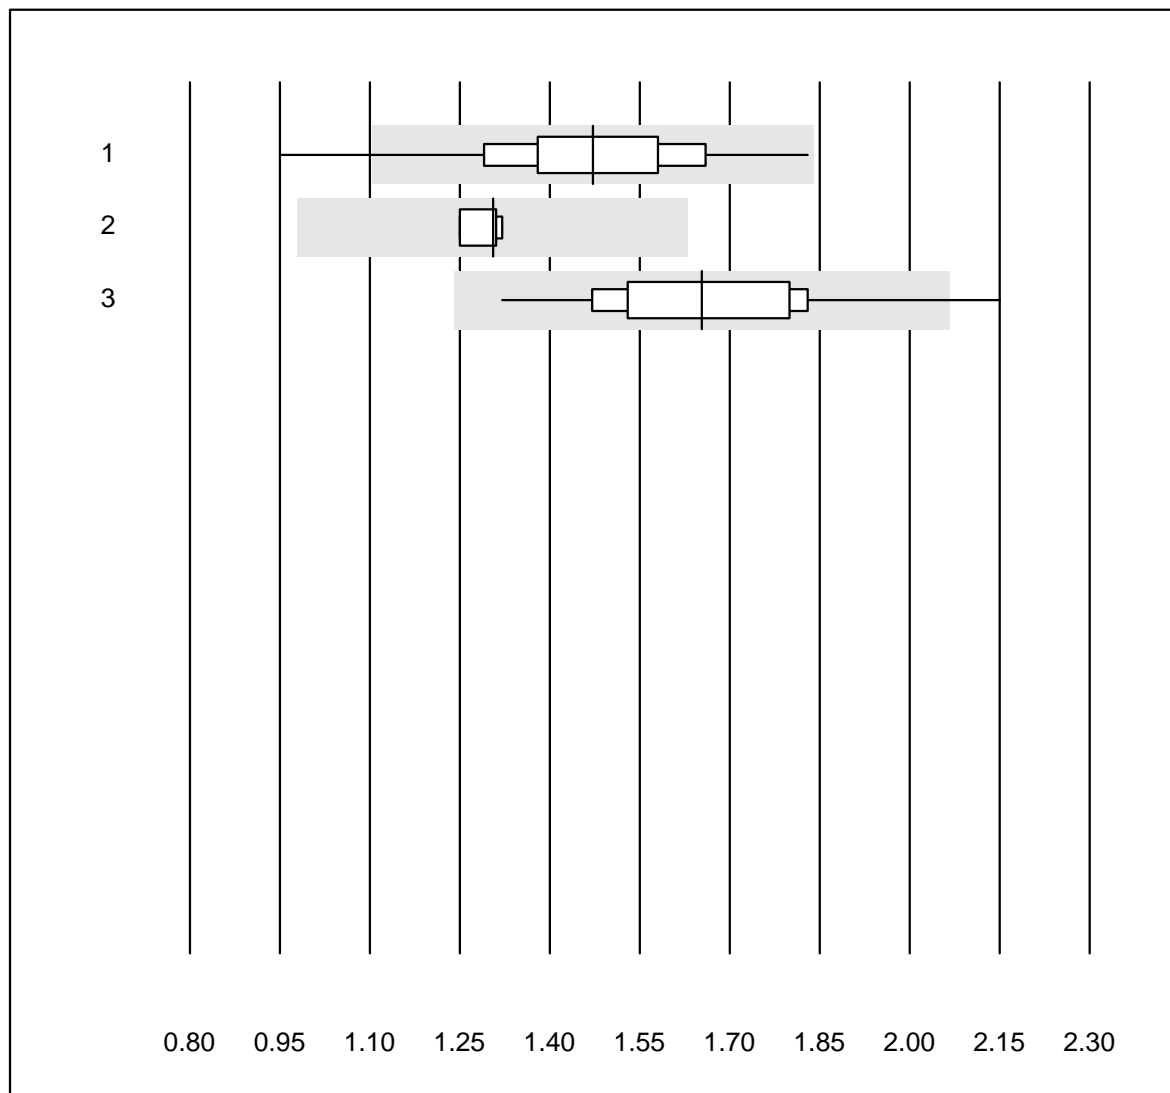


Tolérance MQ : 25 %

Lymphocytes (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Sysmex	76	98.7	1.3	0.0	1.47	9.9	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	1.31	2.4	e
3 Yumizen/Pentra	15	80.0	6.7	13.3	1.65	12.6	e*

Monocytes

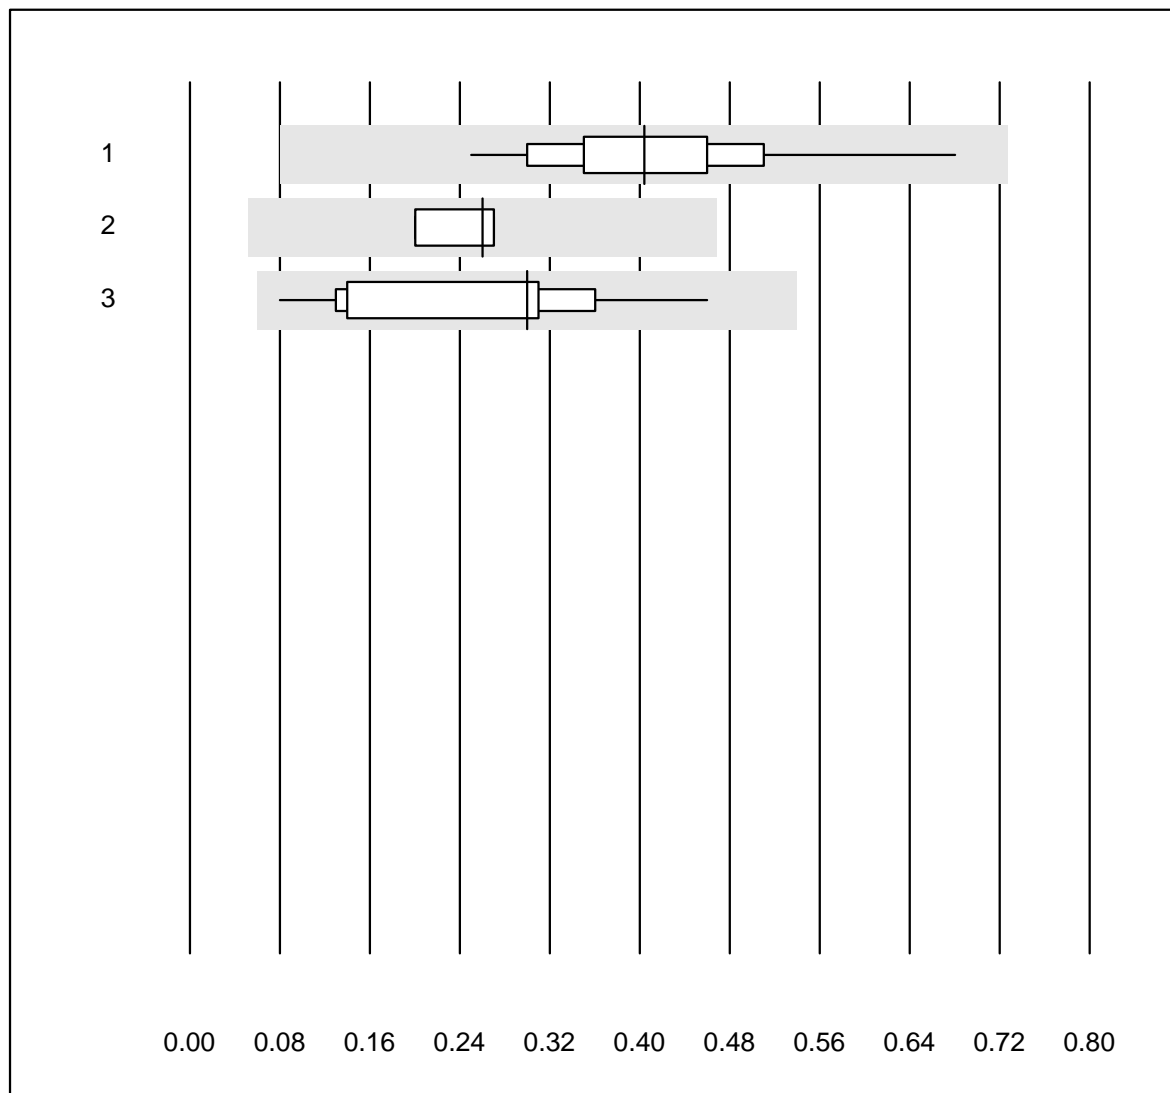


Tolérance MQ : 40 %

Monocytes (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Sysmex	76	98.7	0.0	1.3	0.40	20.6	a
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	0.26	13.3	a
3 Yumizen/Pentra	15	86.7	0.0	13.3	0.30	42.1	a

Eosinophiles

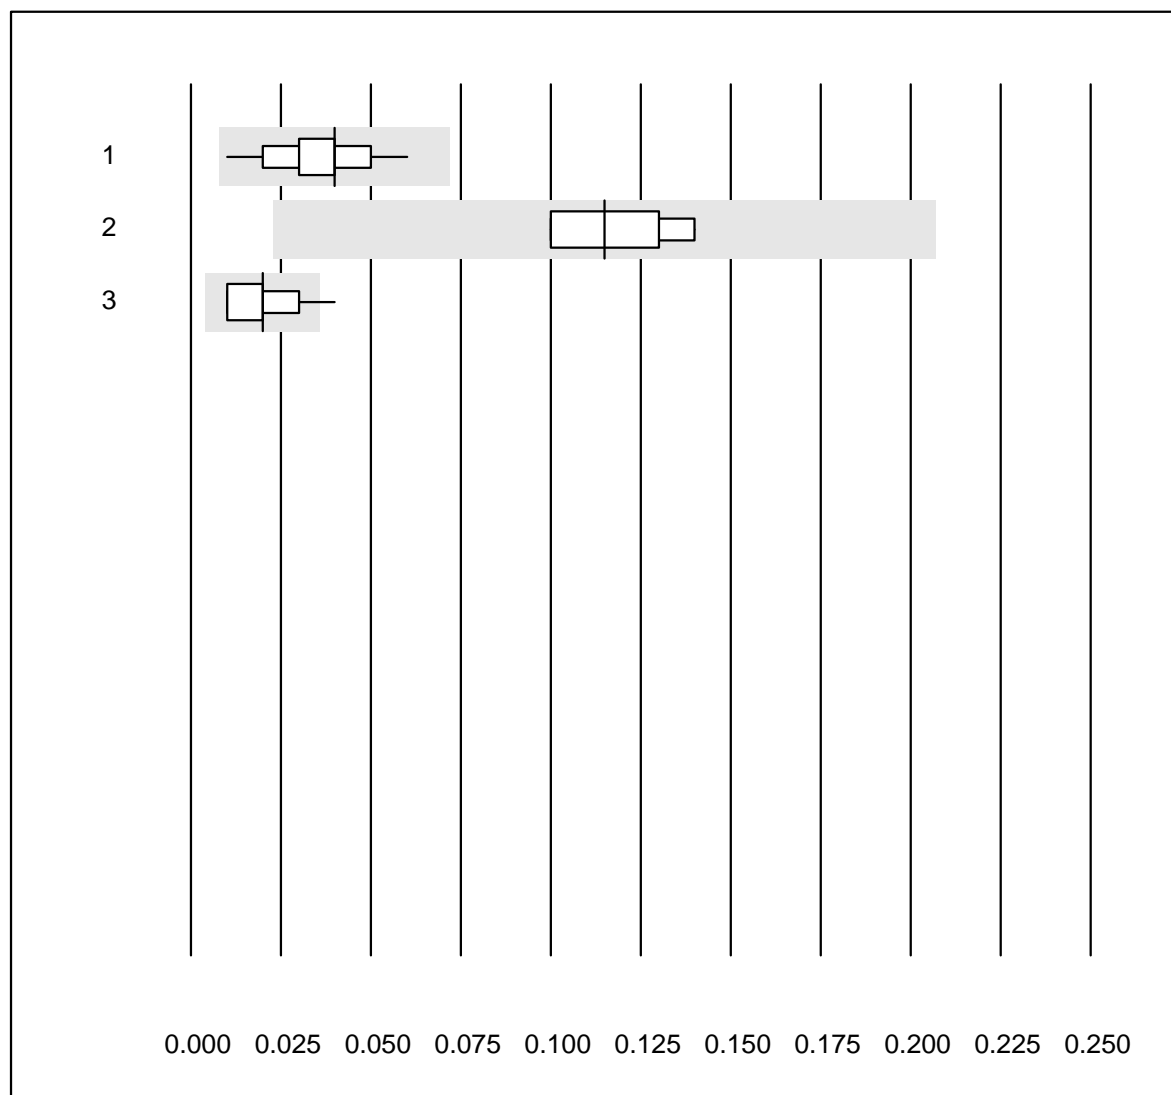


Tolérance MQ : 80 %

Eosinophiles (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Sysmex	73	98.6	0.0	1.4	0.04	32.5	a
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	0.12	17.5	e
3 Yumizen/Pentra	15	73.3	6.7	20.0	0.02	51.8	a

Basophiles

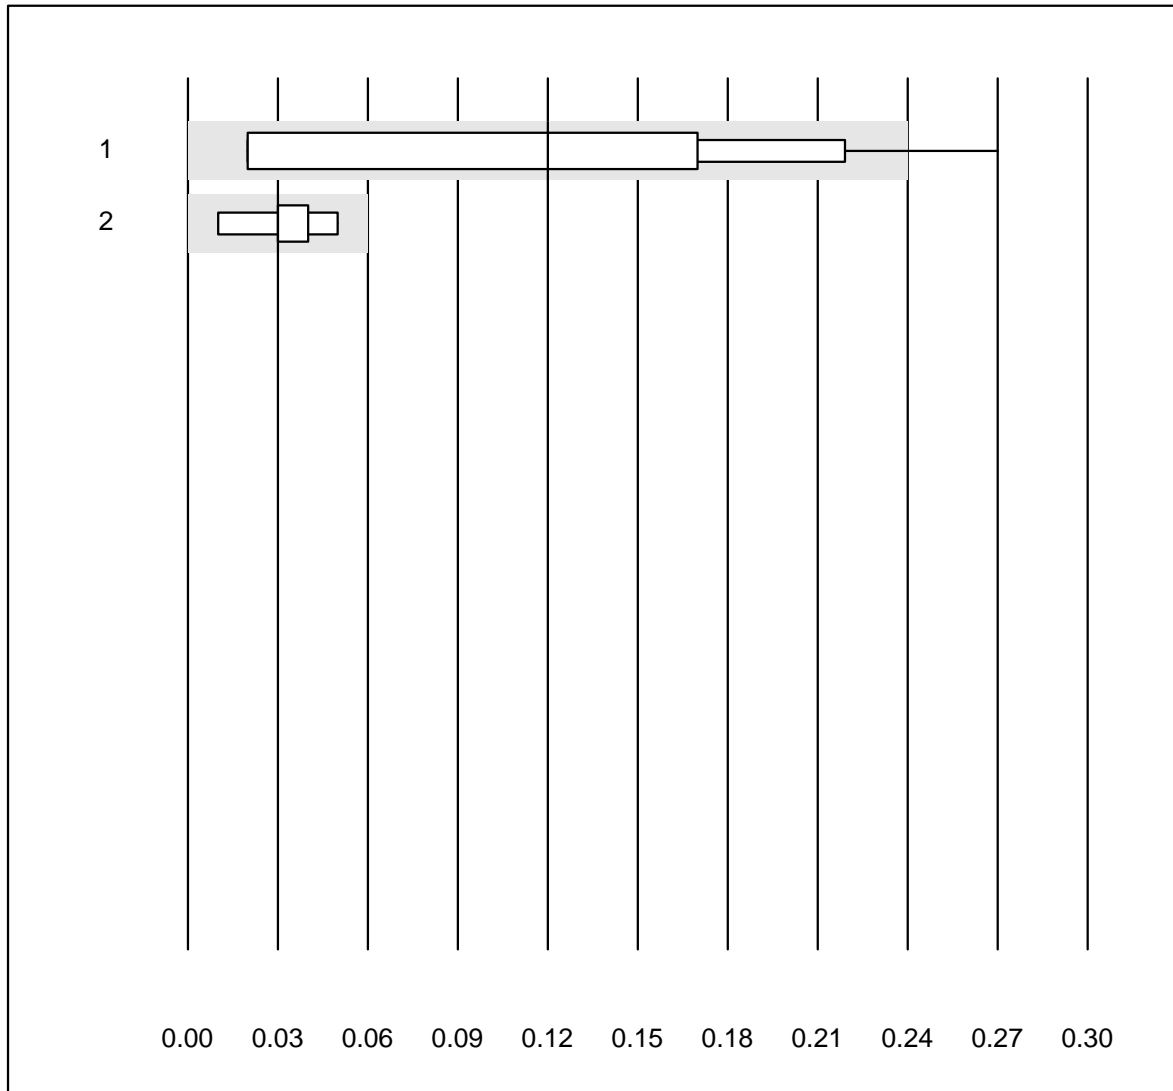


Tolérance MQ : 80 %
(< 0.10: +/- 0.08 G/l)

Basophiles (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Sysmex	75	89.3	6.7	4.0	0.12	83.2	a
2 Yumizen/Pentra	15	86.7	0.0	13.3	0.03	40.6	a

MCV

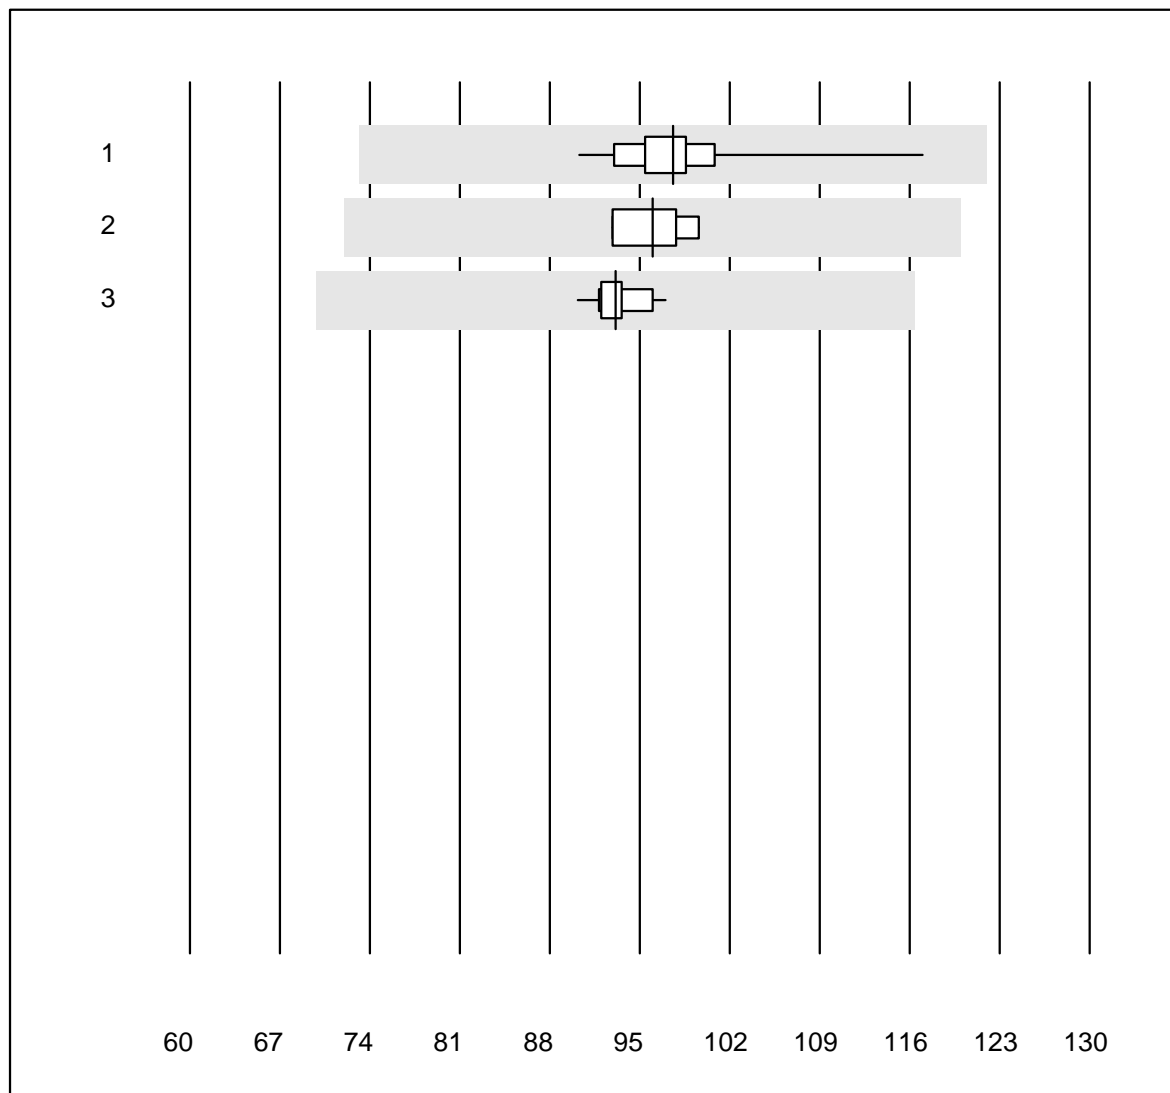


Tolérance MQ : 25 %

MCV (fl)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Sysmex	70	100.0	0.0	0.0	97.6	4.6	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	96.0	3.2	e
3 Yumizen/Pentra	11	100.0	0.0	0.0	93.1	2.0	e

MCH

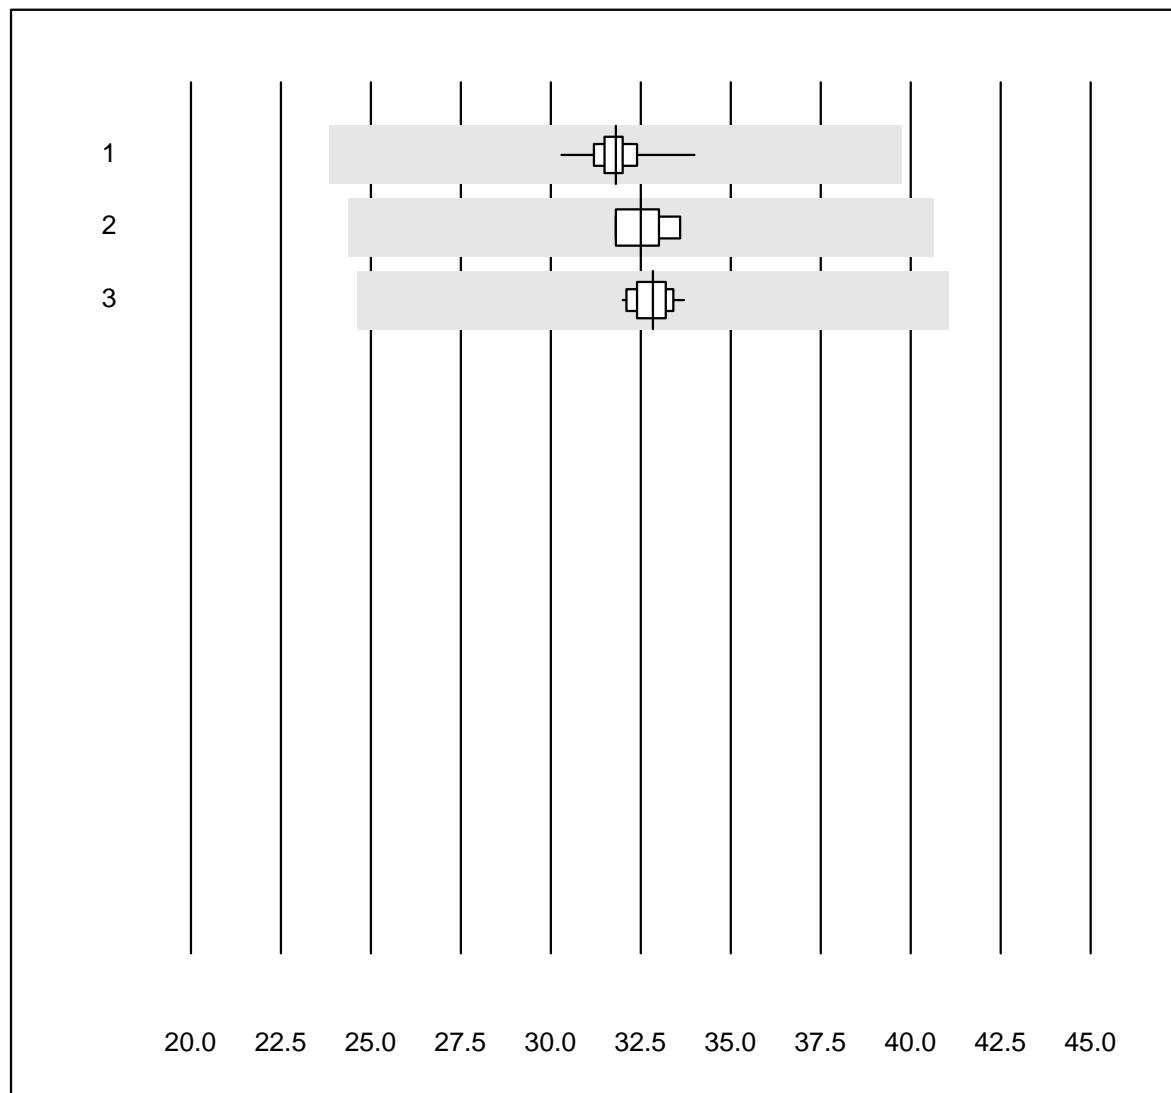


Tolérance MQ : 25 %

MCH (pg)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Sysmex	69	100.0	0.0	0.0	31.8	1.7	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	32.5	2.6	e
3 Yumizen/Pentra	11	100.0	0.0	0.0	32.8	1.7	e

MCHC

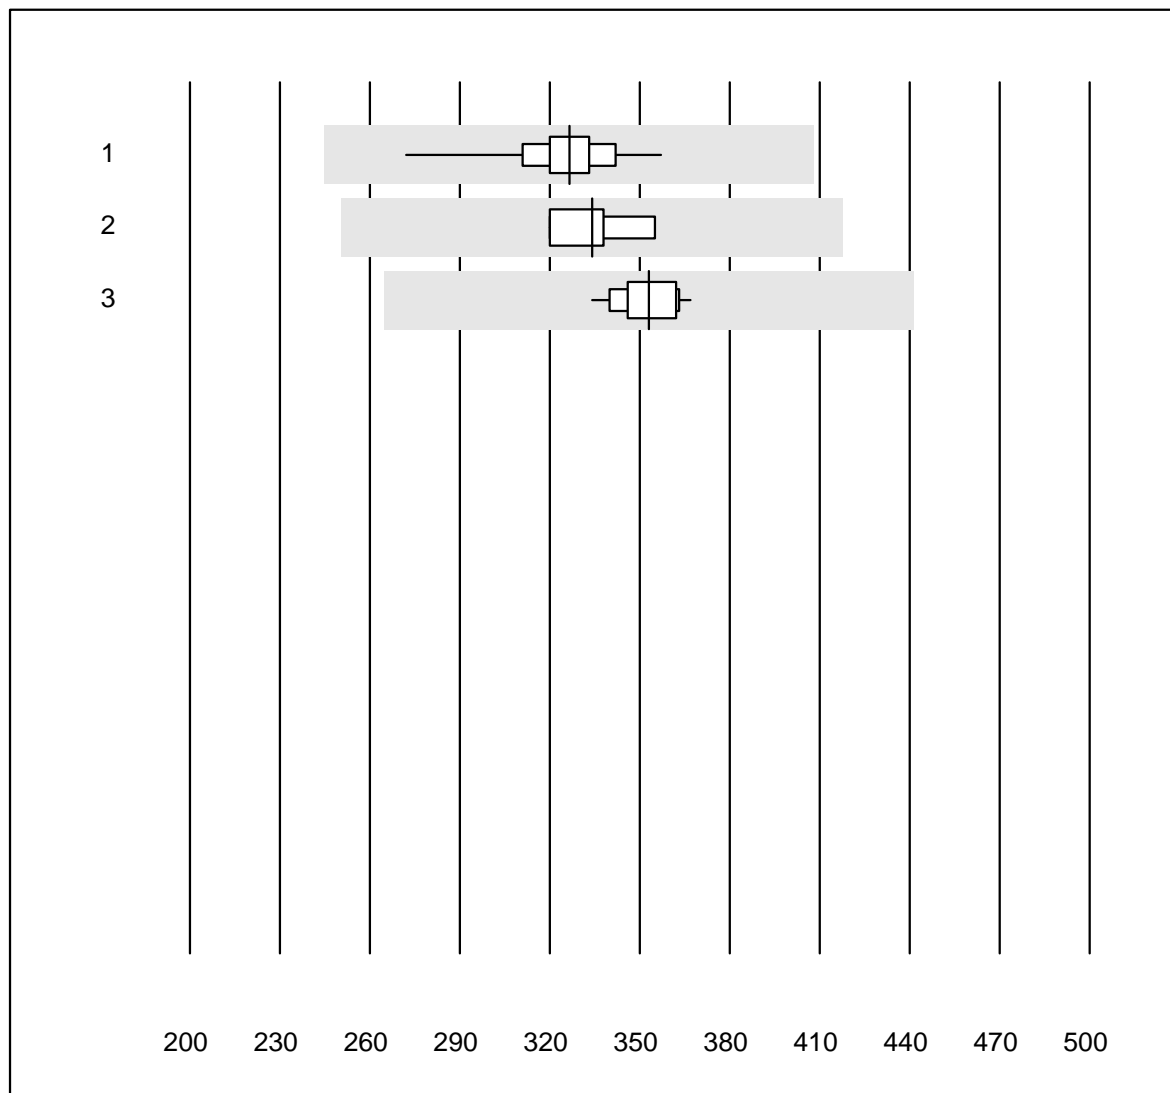


Tolérance MQ : 25 %

MCHC (g/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Sysmex	70	100.0	0.0	0.0	326	4.6	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	334	4.4	e
3 Yumizen/Pentra	11	100.0	0.0	0.0	353	2.8	e

RDW

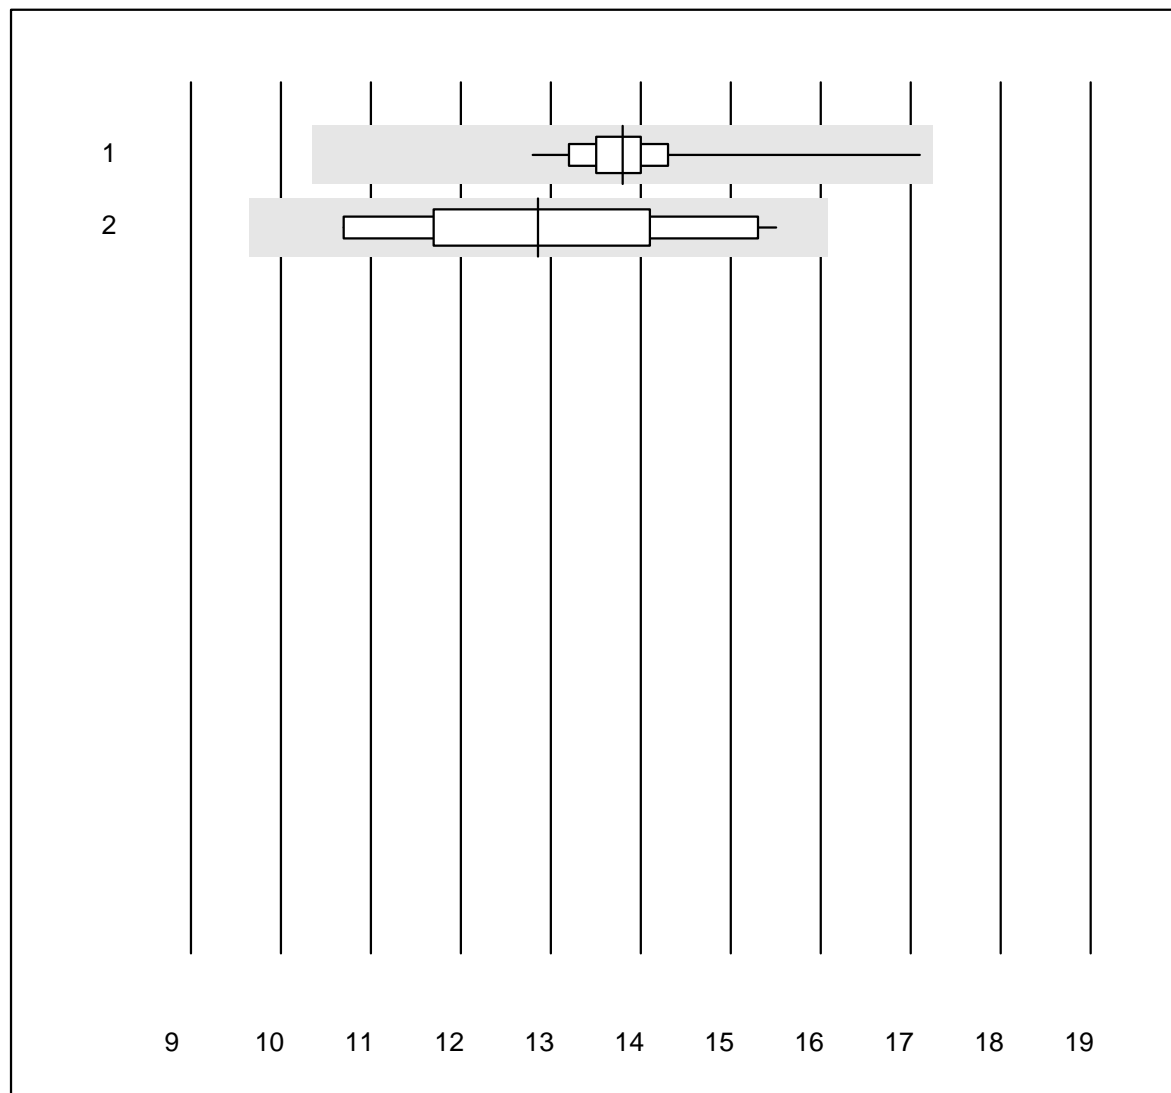


Tolérance MQ : 25 %

RDW (%)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Sysmex	67	98.5	0.0	1.5	13.8	4.8	e
2 Yumizen/Pentra	10	100.0	0.0	0.0	12.9	13.0	e*

Immature Granulocytes

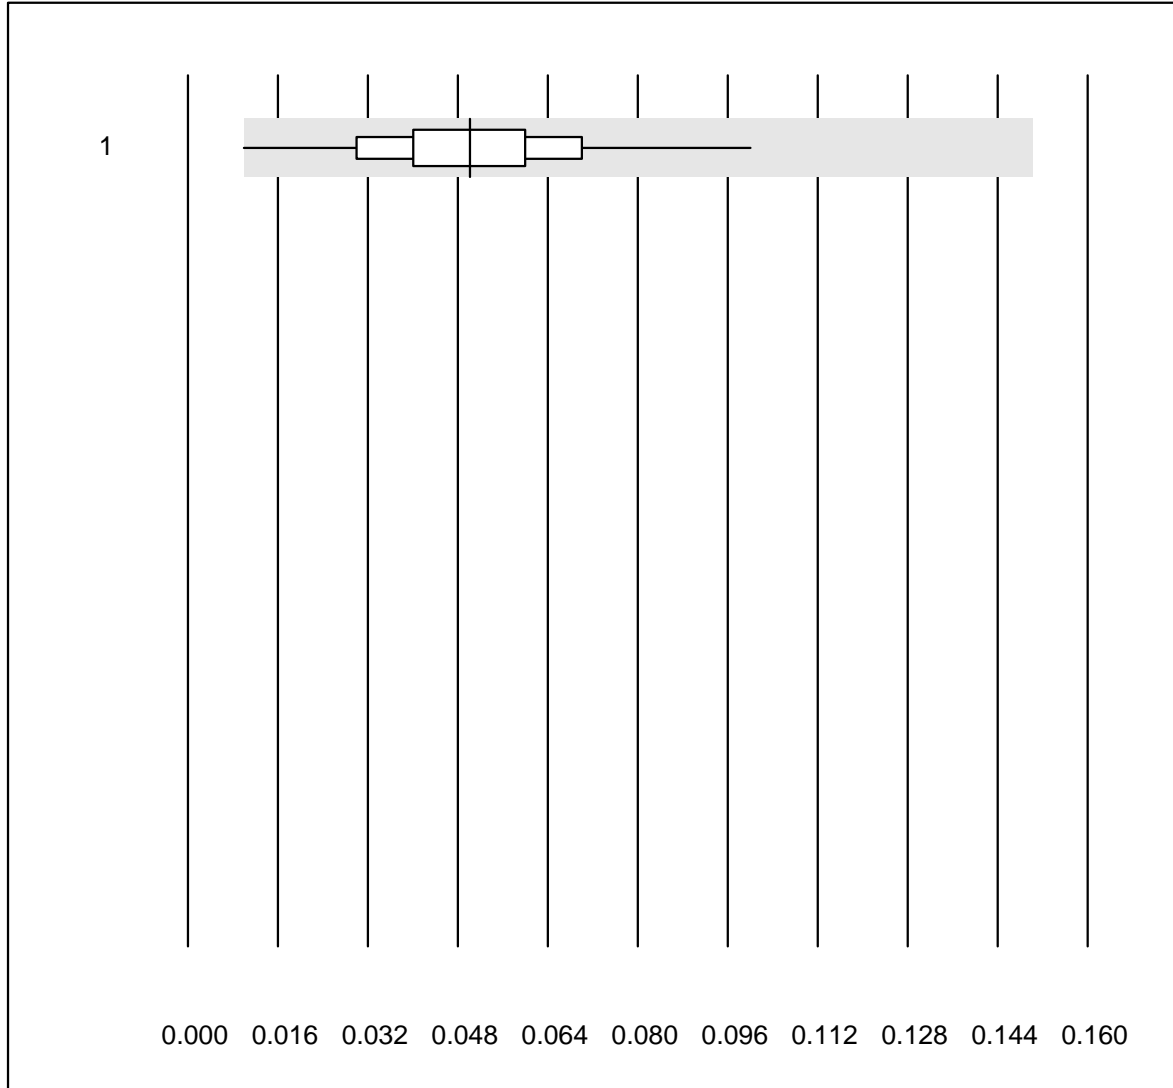


Tolérance MQ : 25 %
 (< 0.10: +/- 0.10 G/l)

Immature Granulocytes (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Sysmex	58	98.3	0.0	1.7	0.05	35.4	e*

Réticulocytes

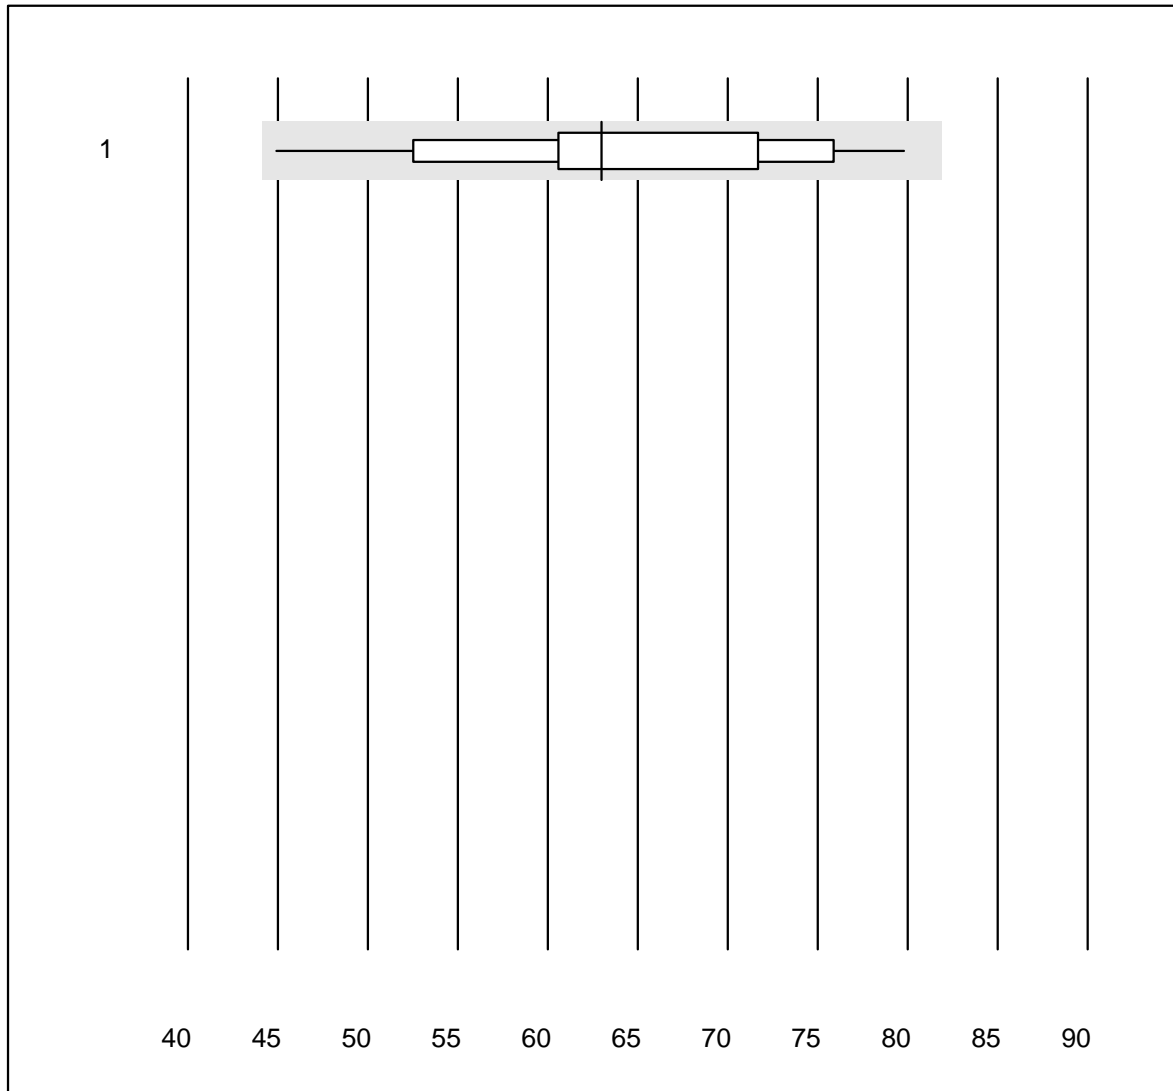


Tolérance MQ : 30 %

Réticulocytes (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Sysmex	38	100.0	0.0	0.0	63.0	12.3	a

Index hémolytique échantillon A

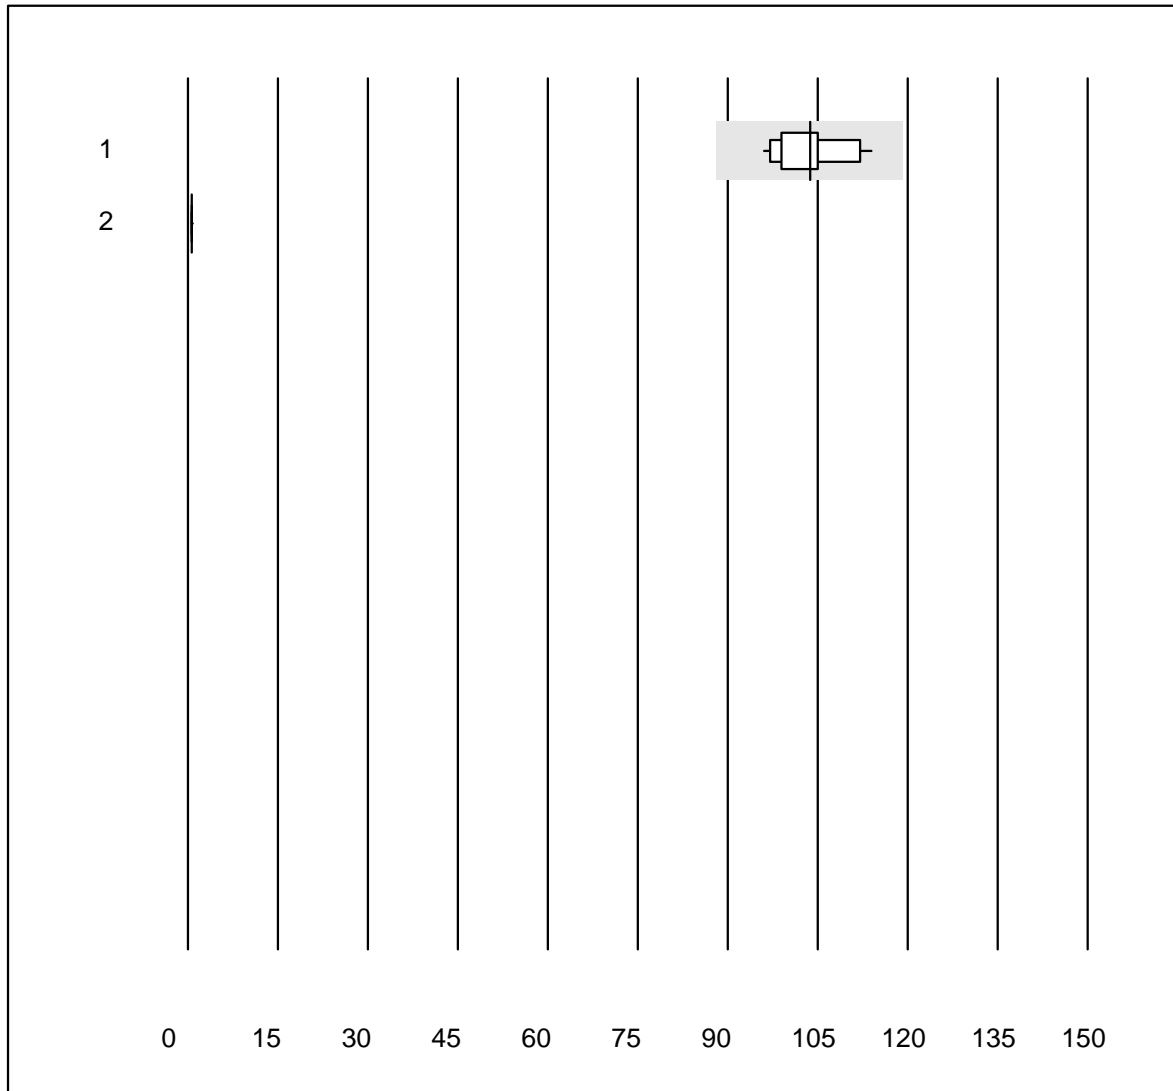


Tolérance MQ : 15 %

Index hémolytique échantillon A ()

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas	16	100.0	0.0	0.0	103.69	4.7	e
2 Architect	7	85.7	0.0	14.3	0.65	6.8	e*

Index hémolytique échantillon B

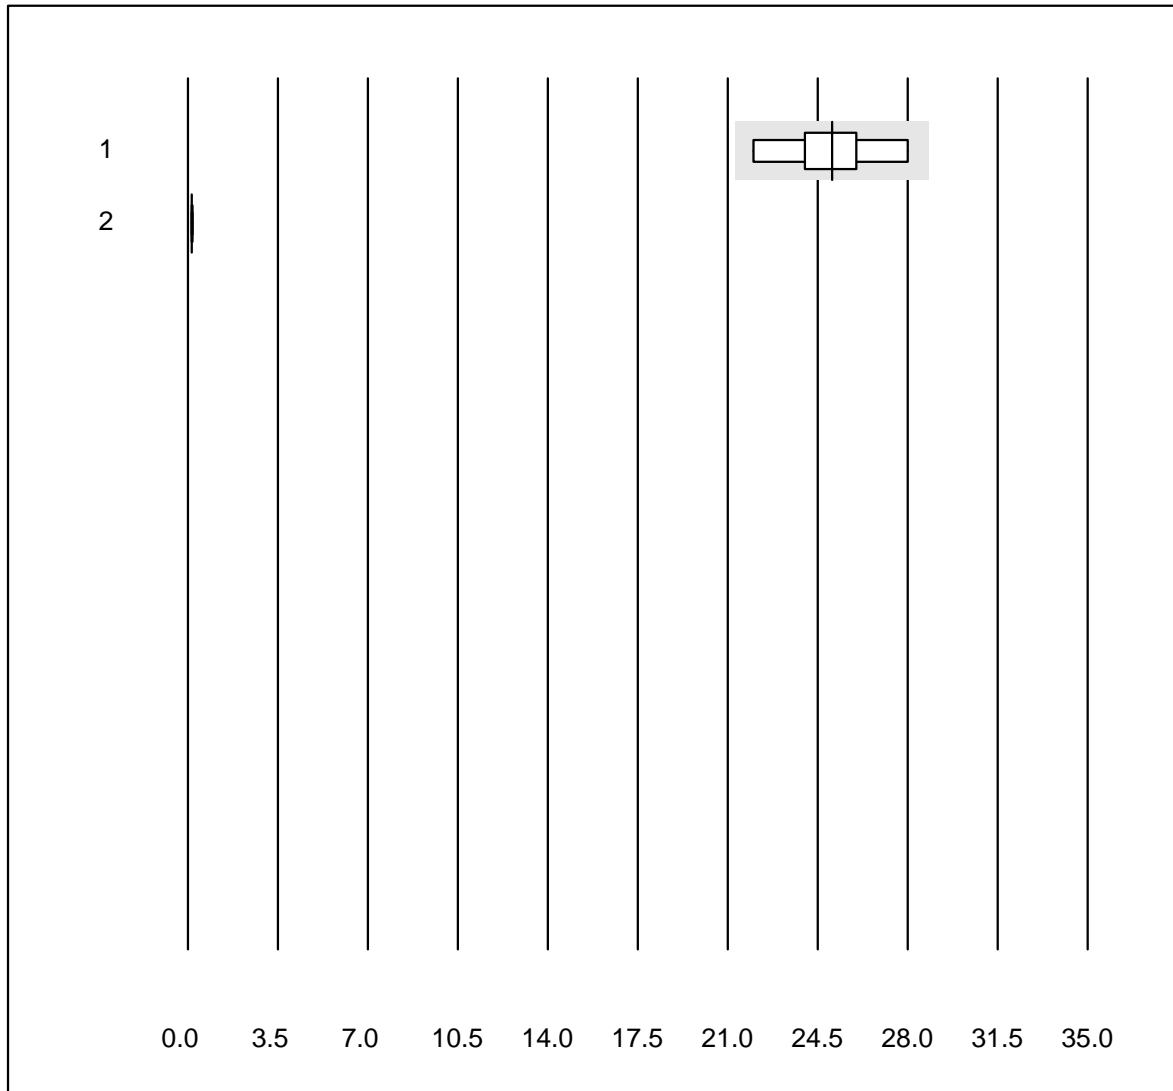


Tolérance MQ : 15 %

Index hémolytique échantillon B ()

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	25.06	7.0	e
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	0.16	6.3	e*

Vitesse de sédimentation 1h

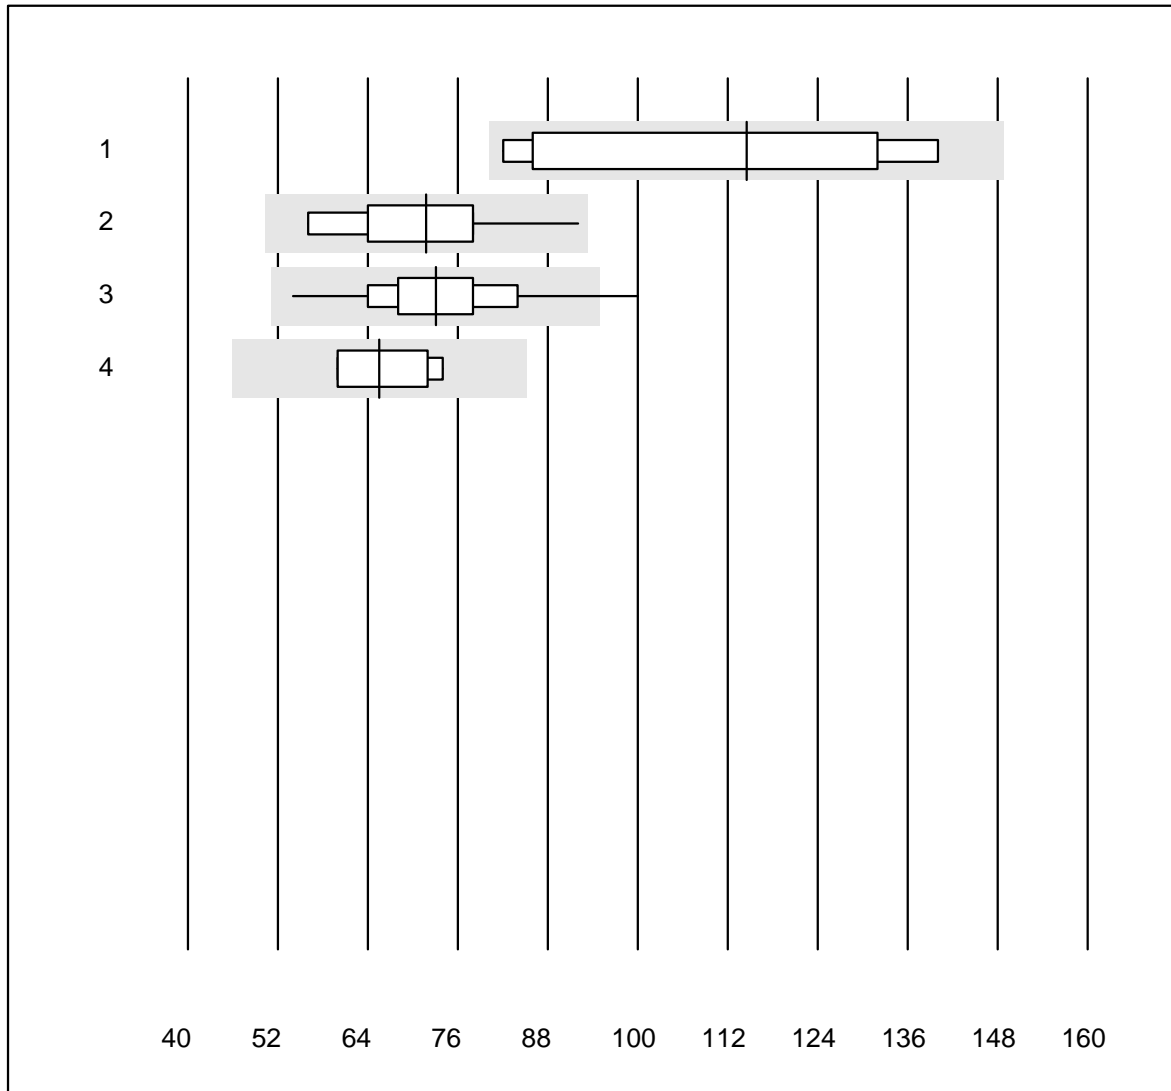


Tolérance MQ : 30 %

Vitesse de sédimentation 1h (mm/h)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 MINI-CUBE	8	100.0	0.0	0.0	115	20.4	e*
2 Sarstedt Sedivette	11	90.9	0.0	9.1	72	14.1	e*
3 BD Seditainer	40	90.0	2.5	7.5	73	11.9	e
4 Autres méthodes	6	100.0	0.0	0.0	66	10.3	e*

Vitesse de sédimentation 2h

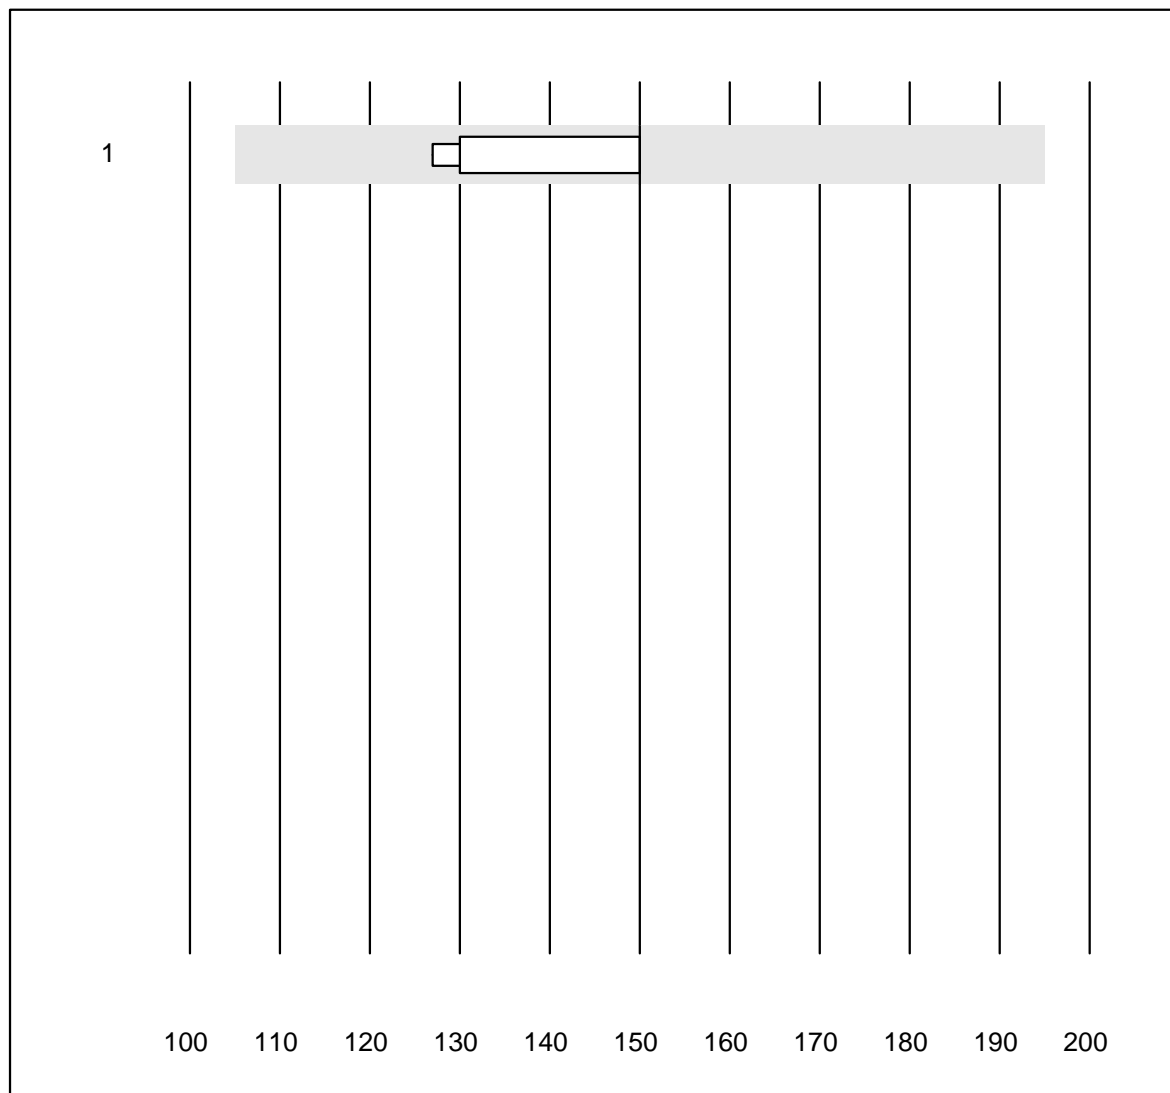


Tolérance MQ : 30 %

Vitesse de sédimentation 2h (mm/2h)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 BD Seditainer	5	100.0	0.0	0.0	150	8.4	e*

CRP

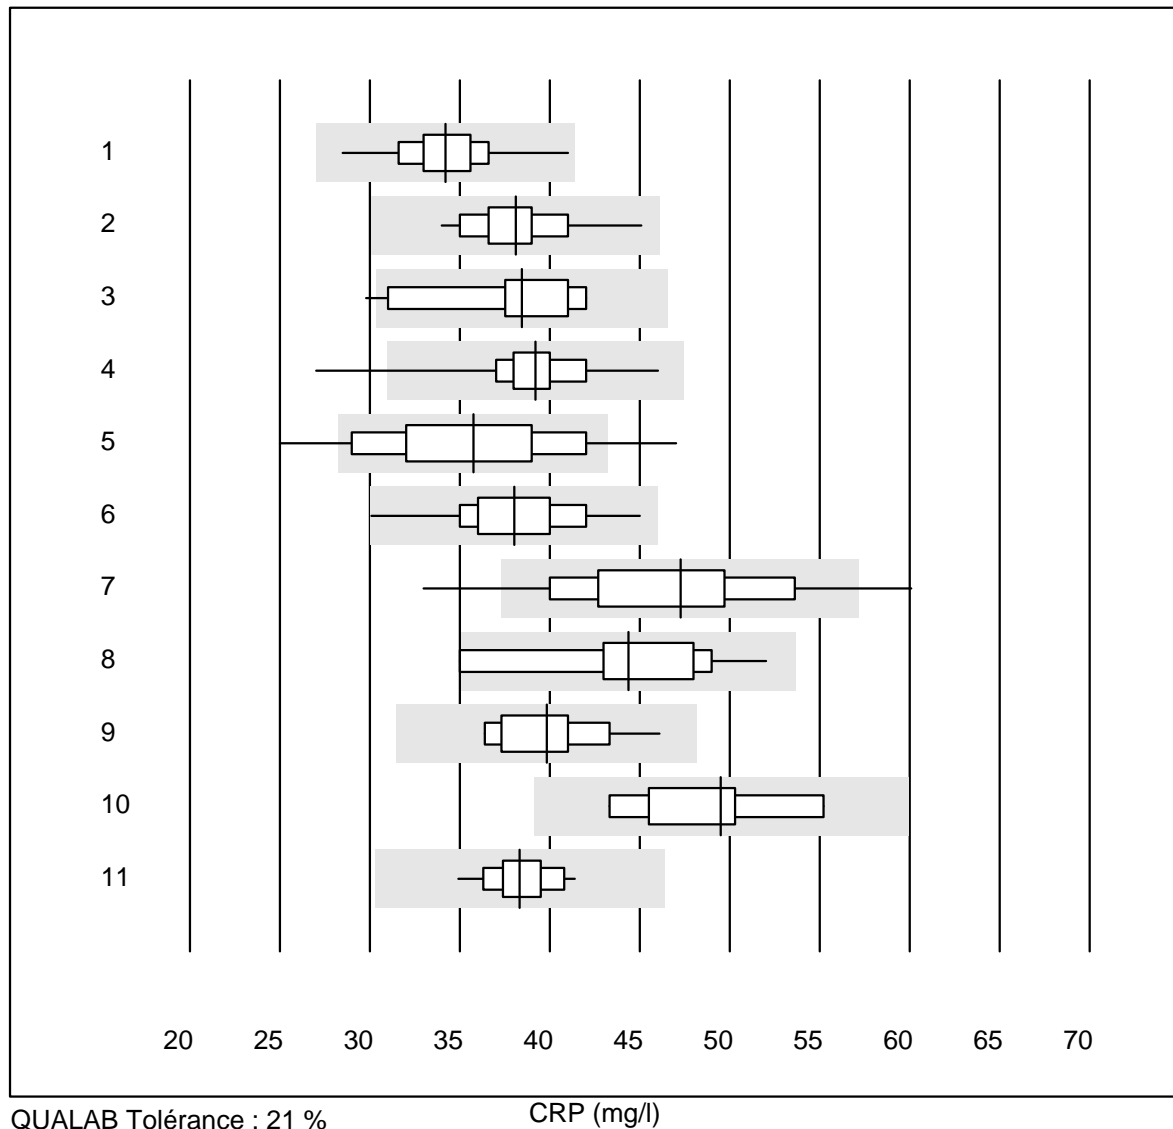


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas b101	300	99.7	0.0	0.3	34.2	5.6	e
2 Cobas	22	100.0	0.0	0.0	38.1	6.9	e
3 Turbidimetrie	15	93.3	6.7	0.0	38.5	9.4	e
4 Afinion	1238	99.6	0.2	0.2	39.2	4.8	e
5 NycoCard SingleTest-	106	78.3	12.3	9.4	35.7	13.6	e
6 Quick Read go	102	99.0	0.0	1.0	38.0	7.7	e
7 Eurolyser	90	74.4	8.9	16.7	47.3	12.3	e
8 Fuji Dri-Chem	14	85.7	14.3	0.0	44.4	11.5	e*
9 Autolyser/DiaSys	11	90.9	0.0	9.1	39.8	7.6	e
10 Piccolo	8	100.0	0.0	0.0	49.5	7.5	e*
11 Celltac chemi	49	100.0	0.0	0.0	38.3	4.1	e

CRP

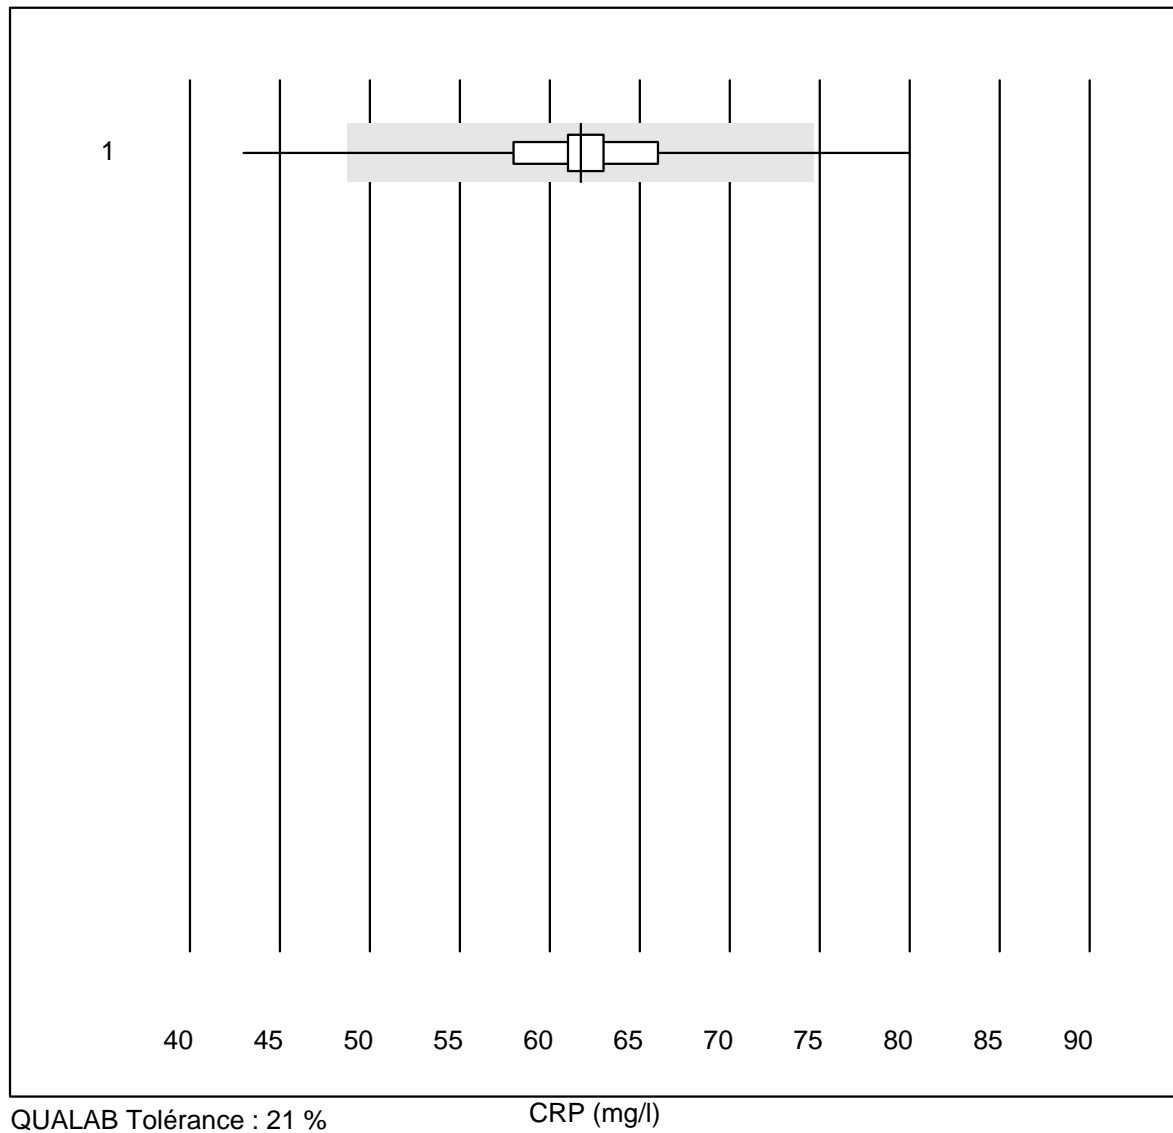


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 QuickRead (sang comp	32	93.7	6.3	0.0	61.7	8.7	e

CRP

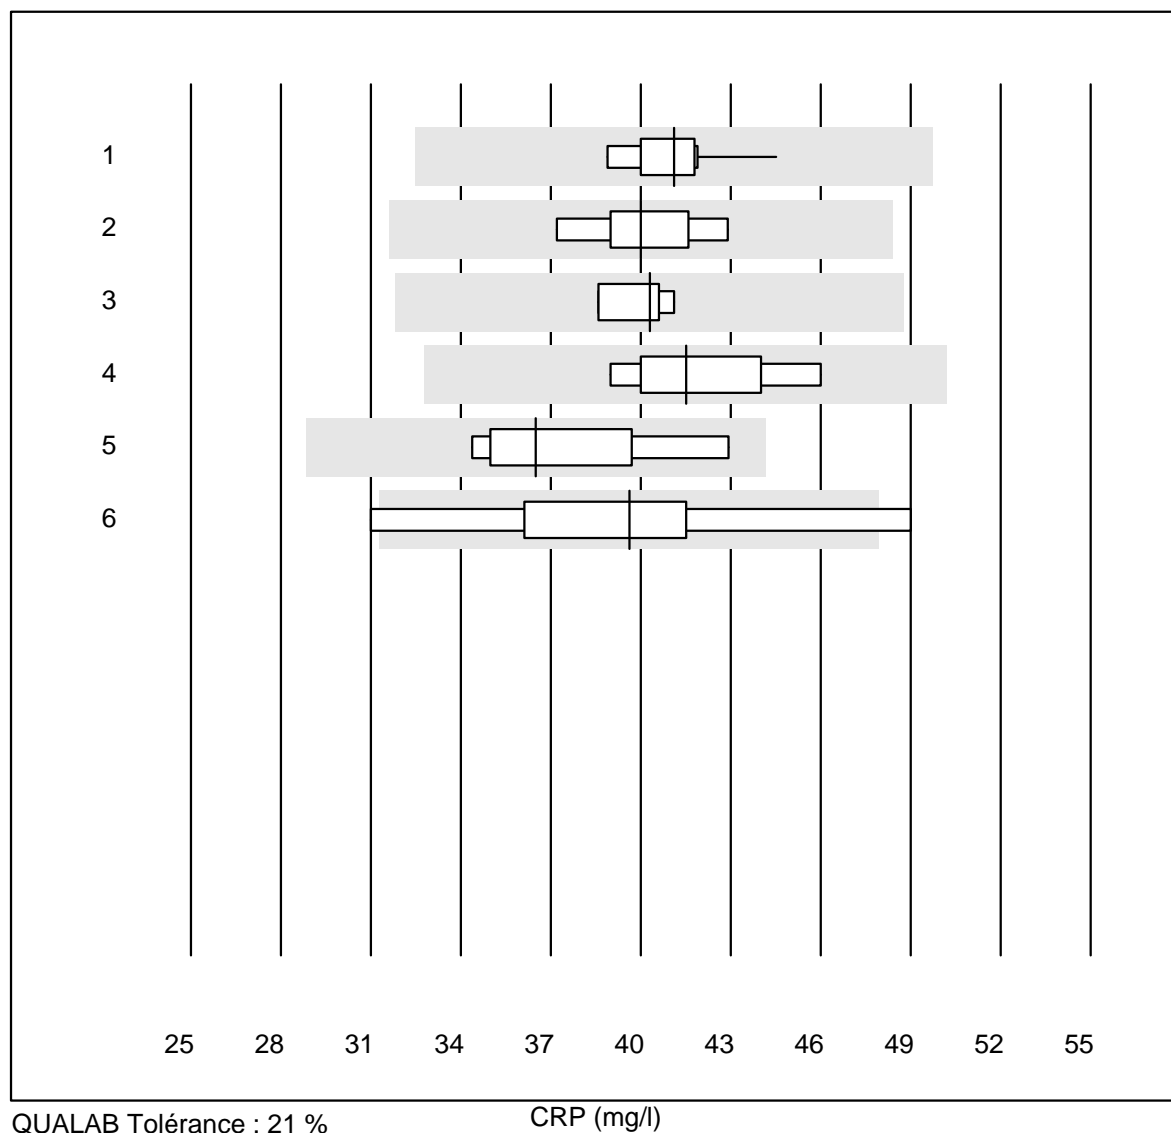

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Spinit	10	100.0	0.0	0.0	41.1	3.7	e
2 Architect	7	100.0	0.0	0.0	40.0	4.6	e
3 Beckman	4	100.0	0.0	0.0	40.3	2.7	e
4 AQT 90 FLEX	8	100.0	0.0	0.0	41.5	6.1	e
5 Spotchem D-Concept	6	83.3	0.0	16.7	36.5	9.2	e*
6 Autres méthodes	7	71.4	28.6	0.0	39.6	13.8	e*

IgG

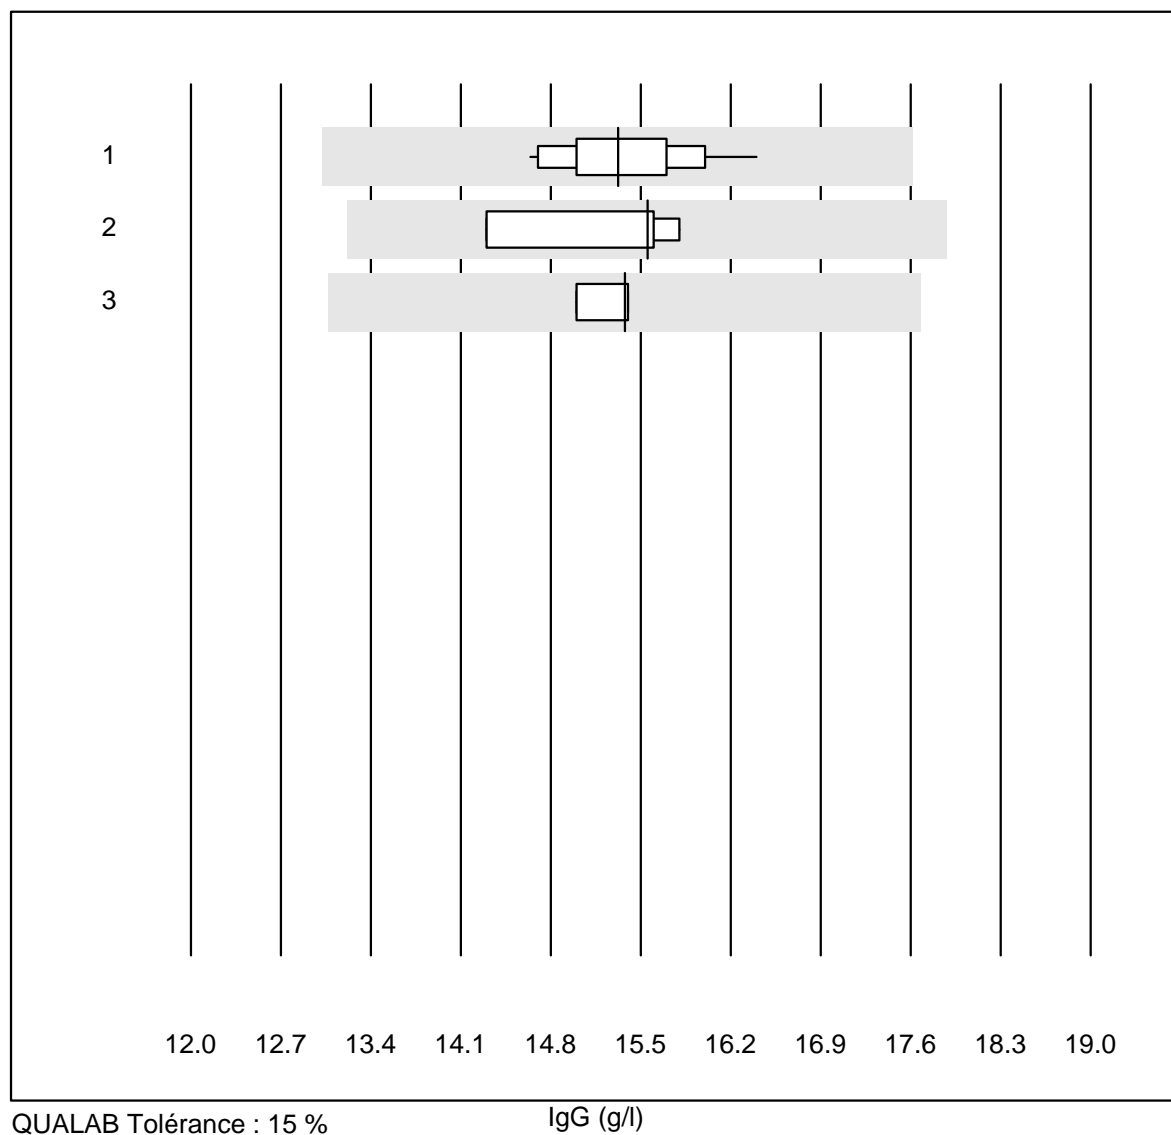


QUALAB Tolérance : 15 %

IgG (g/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Turbidimétrie	18	100.0	0.0	0.0	15.32	3.3	e
2 Nephelométrie	4	100.0	0.0	0.0	15.55	4.4	e*
3 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	15.38	1.3	e

IgA

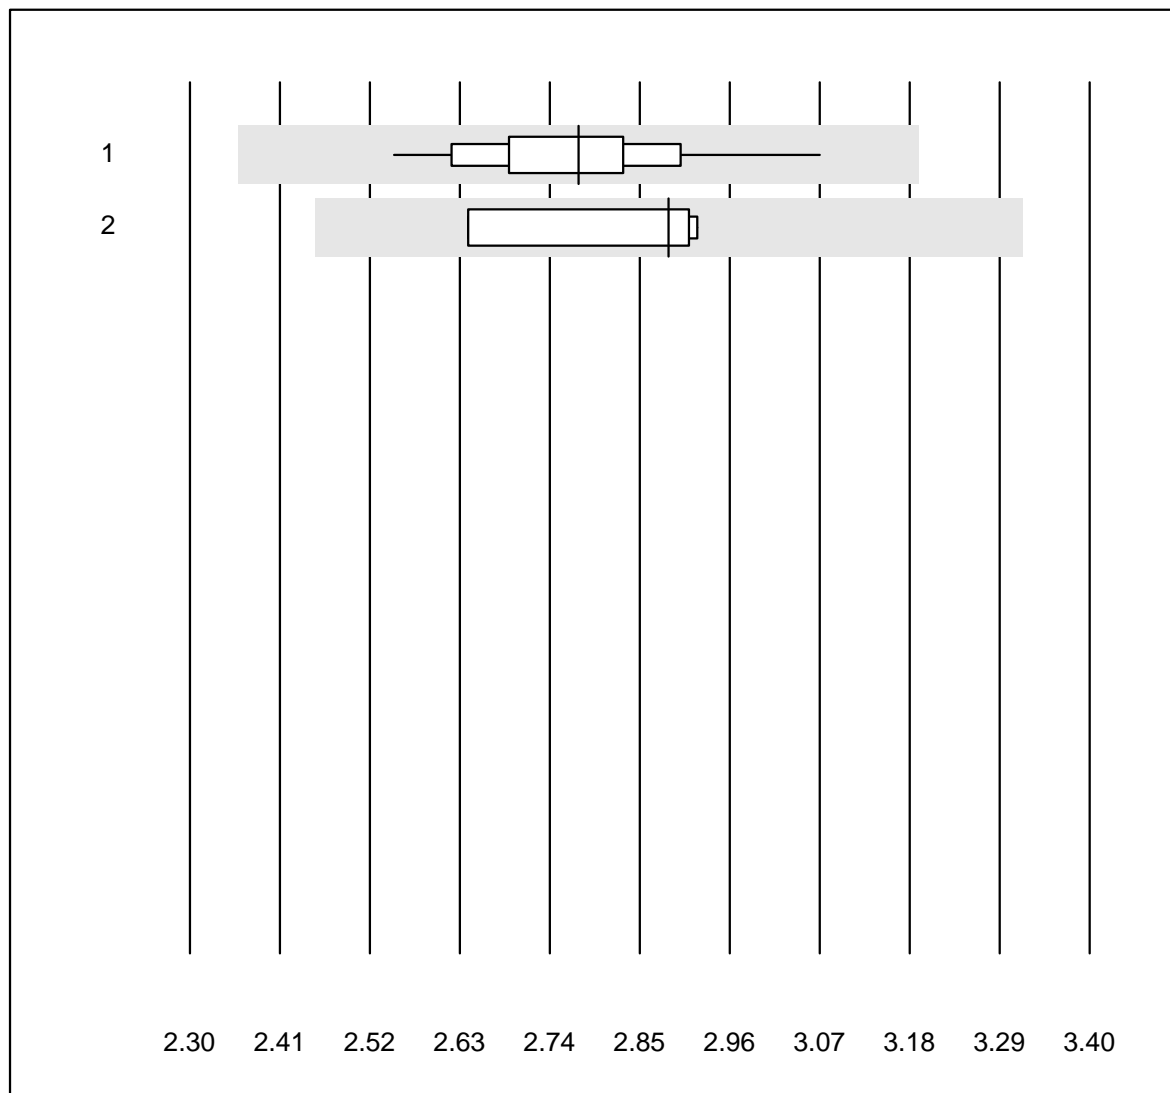


QUALAB Tolérance : 15 %

IgA (g/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Turbidimétrie	18	100.0	0.0	0.0	2.78	4.3	e
2 Néphélométrie	4	100.0	0.0	0.0	2.89	4.6	e*

IgM

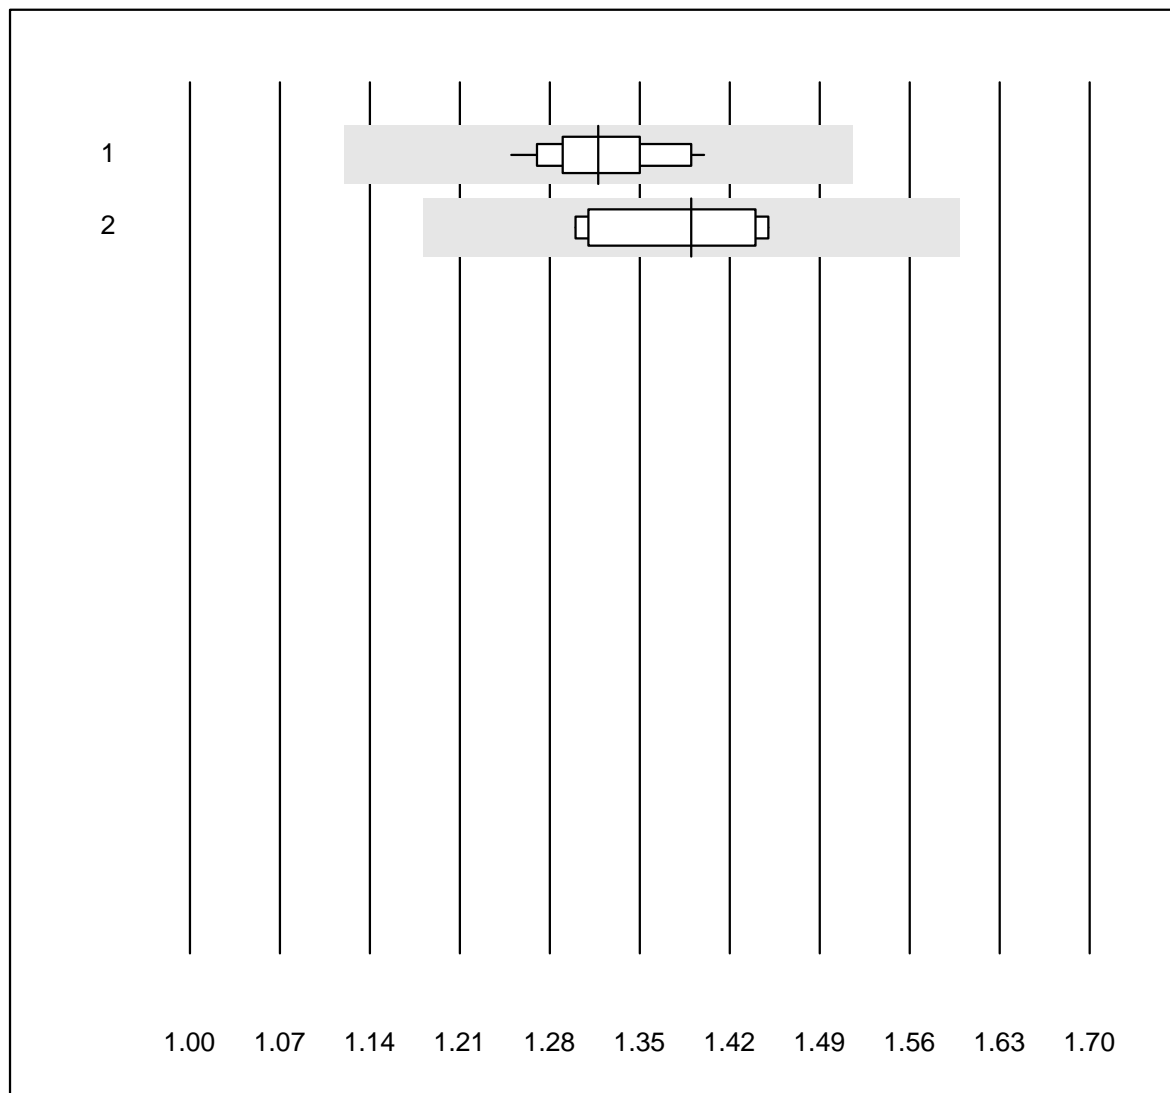


QUALAB Tolérance : 15 %

IgM (g/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Turbidimétrie	17	94.1	0.0	5.9	1.32	3.2	e
2 Néphélométrie	5	100.0	0.0	0.0	1.39	5.1	e*

IgE

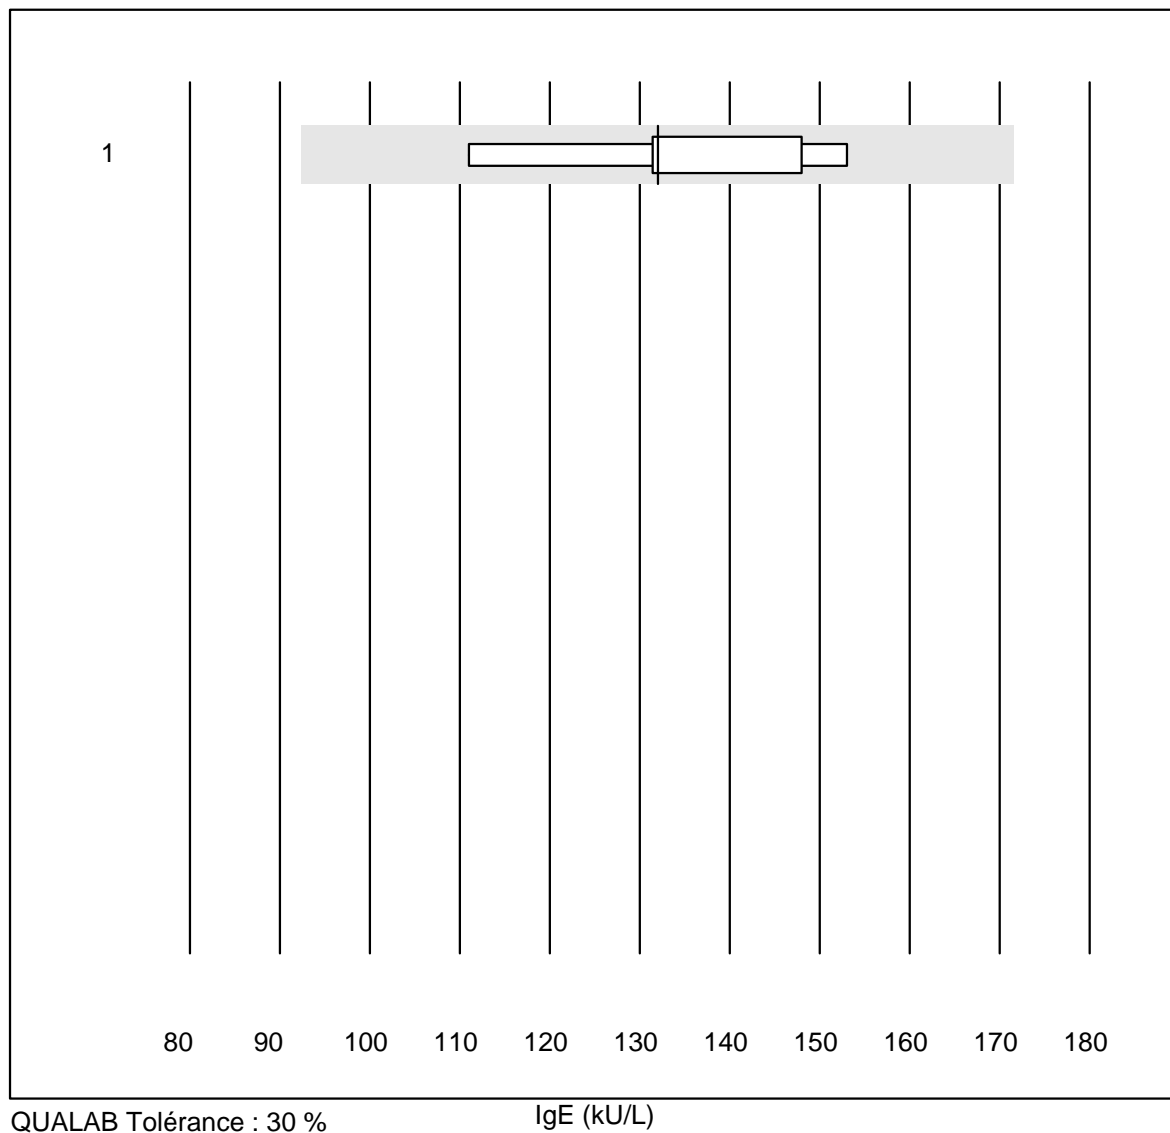


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	132	10.1	e*

Alpha-1-Antitrypsine

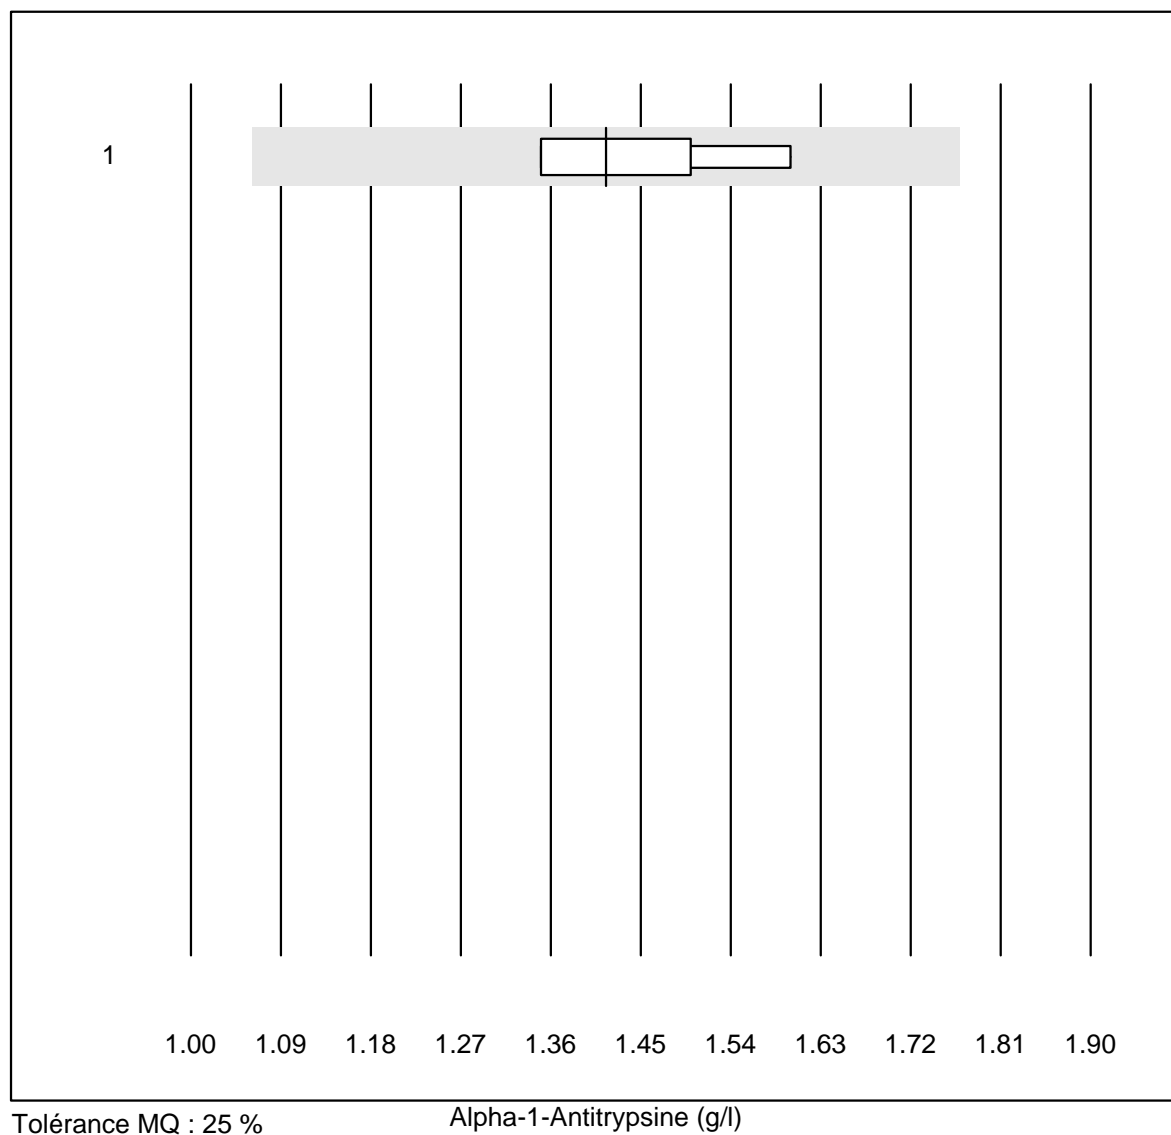

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	8	100.0	0.0	0.0	1.42	7.1	e

Anti-Streptolysine-Anticorps

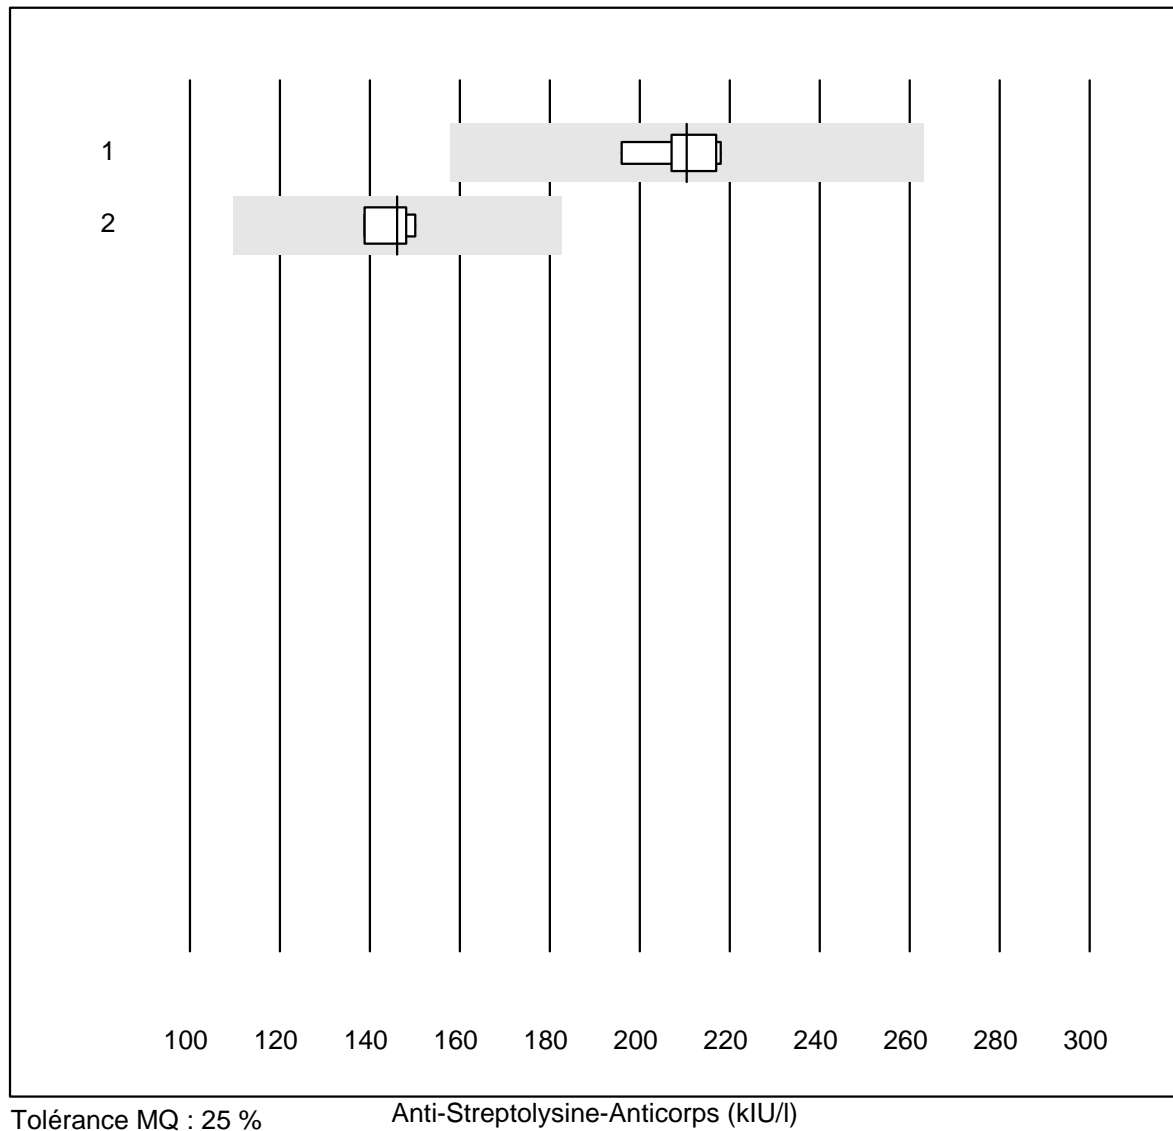


Tolérance MQ : 25 %

Anti-Streptolysine-Anticorps (kIU/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	10	100.0	0.0	0.0	210	3.6	e
2 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	146	3.4	e

Complément C3

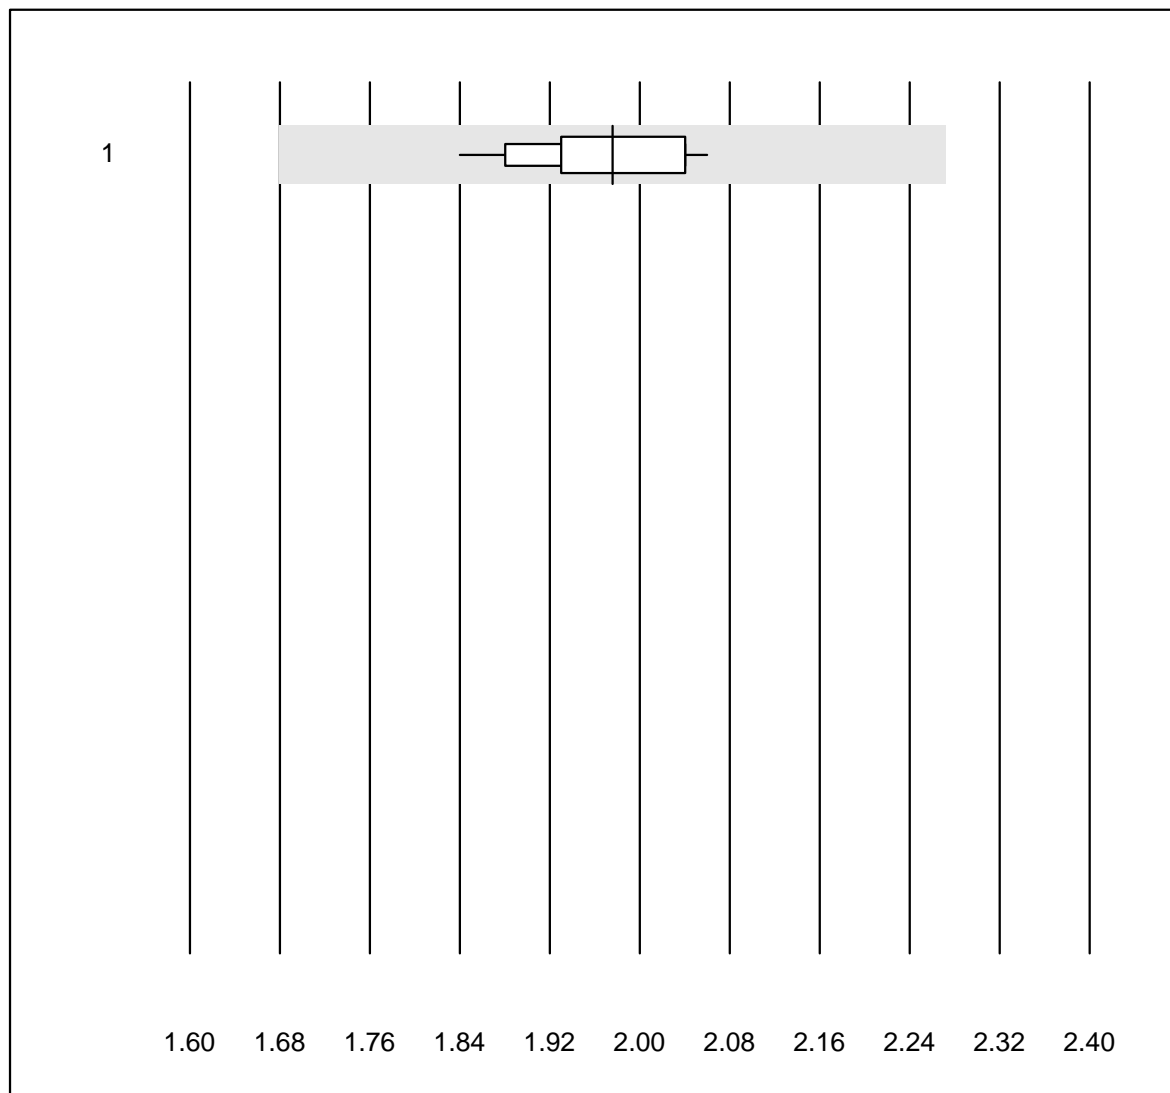


QUALAB Tolérance : 15 %

Complément C3 (g/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	17	100.0	0.0	0.0	1.98	3.4	e

Complément C4

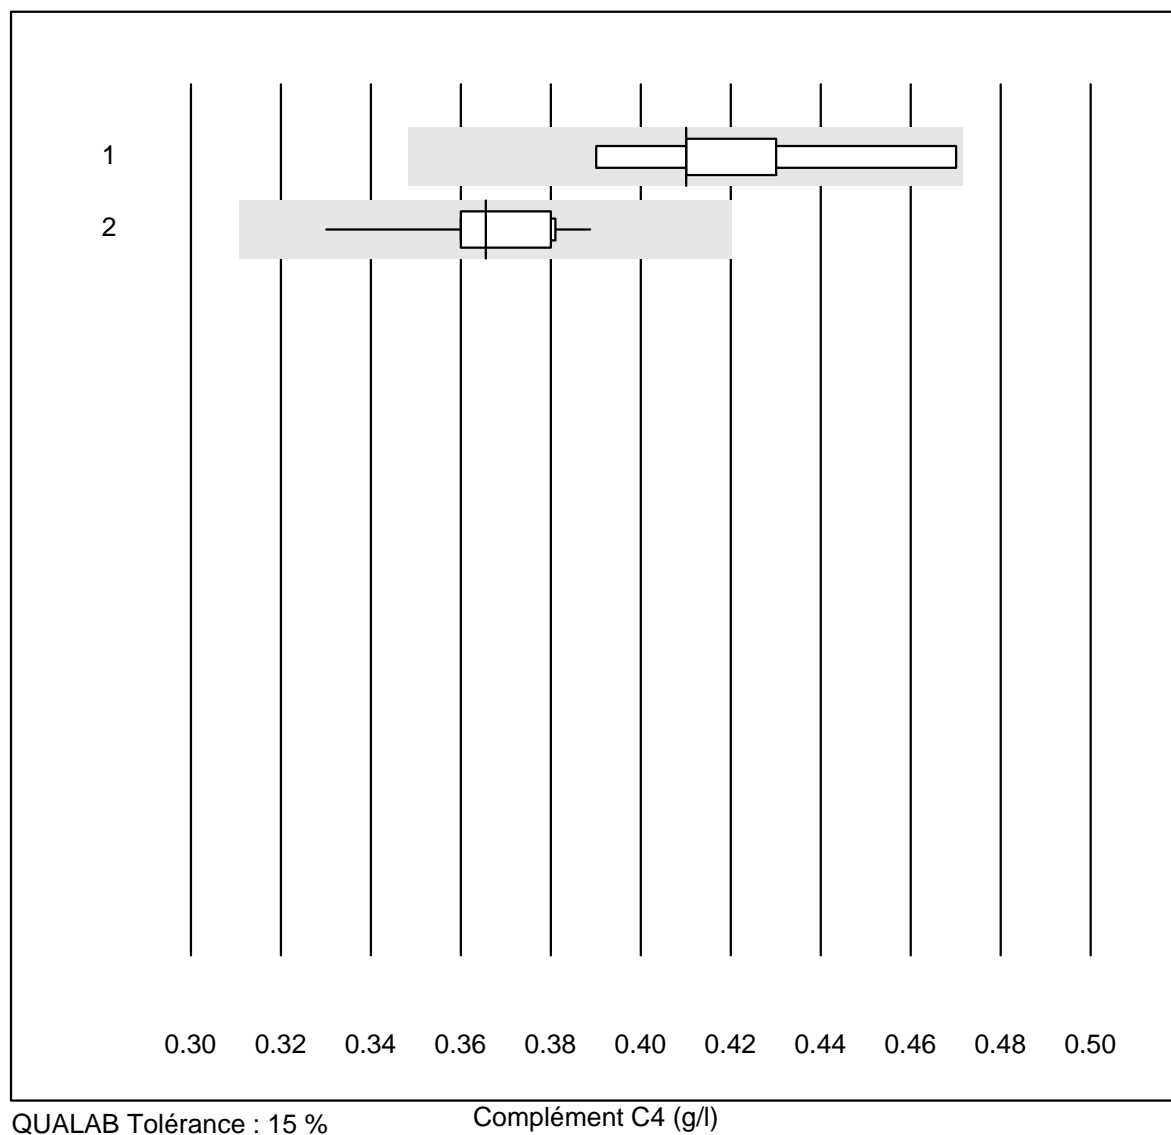


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Alinity	5	100.0	0.0	0.0	0.41	7.2	e*
2 toutes les méthodes	11	100.0	0.0	0.0	0.37	4.3	e

Haptoglobine

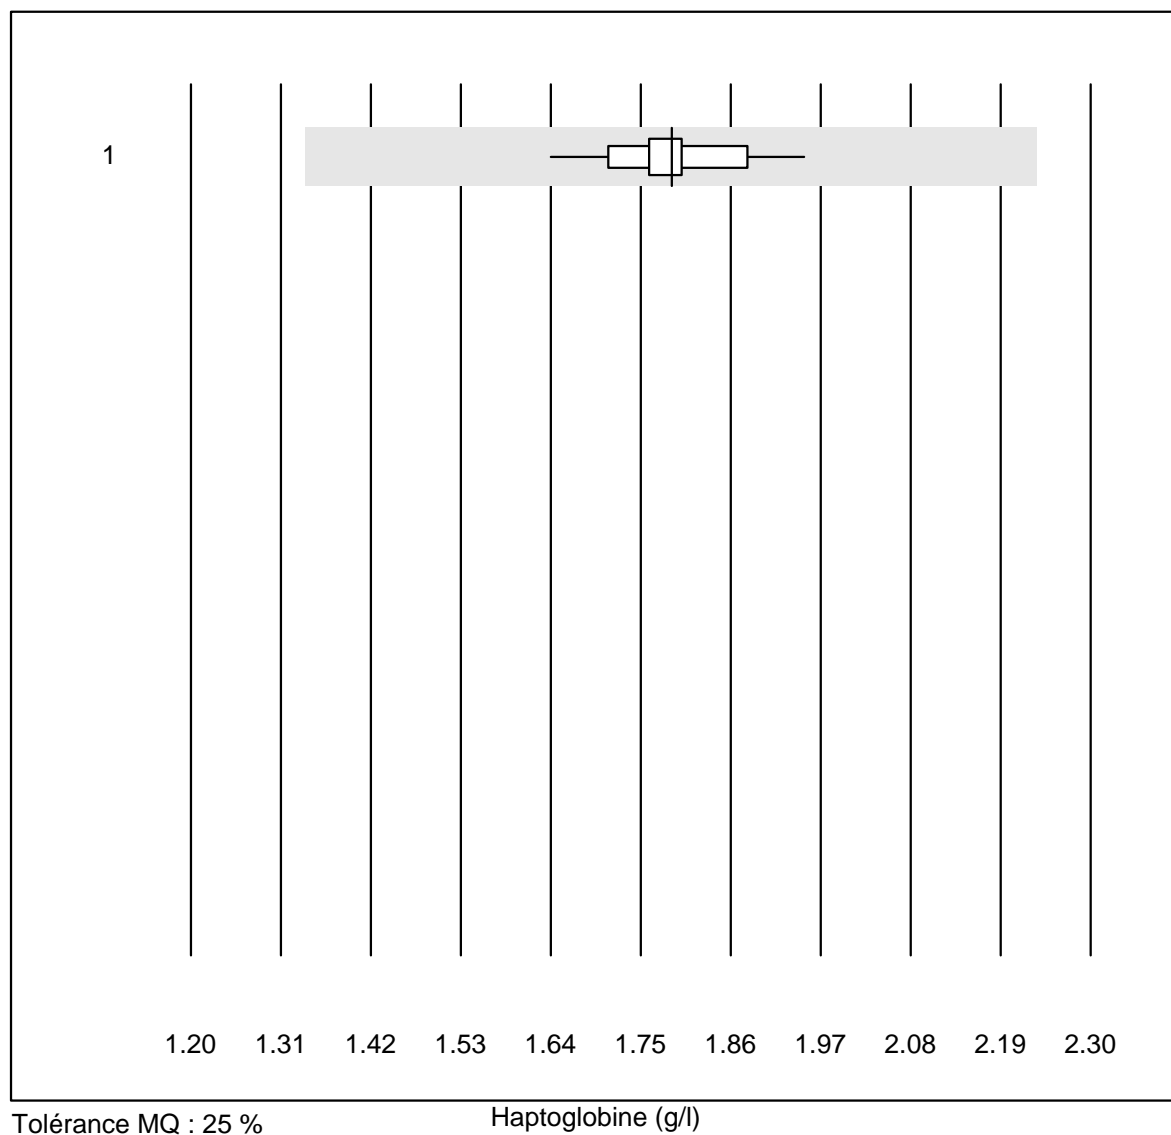


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	22	100.0	0.0	0.0	1.79	3.8	e

Transferrine

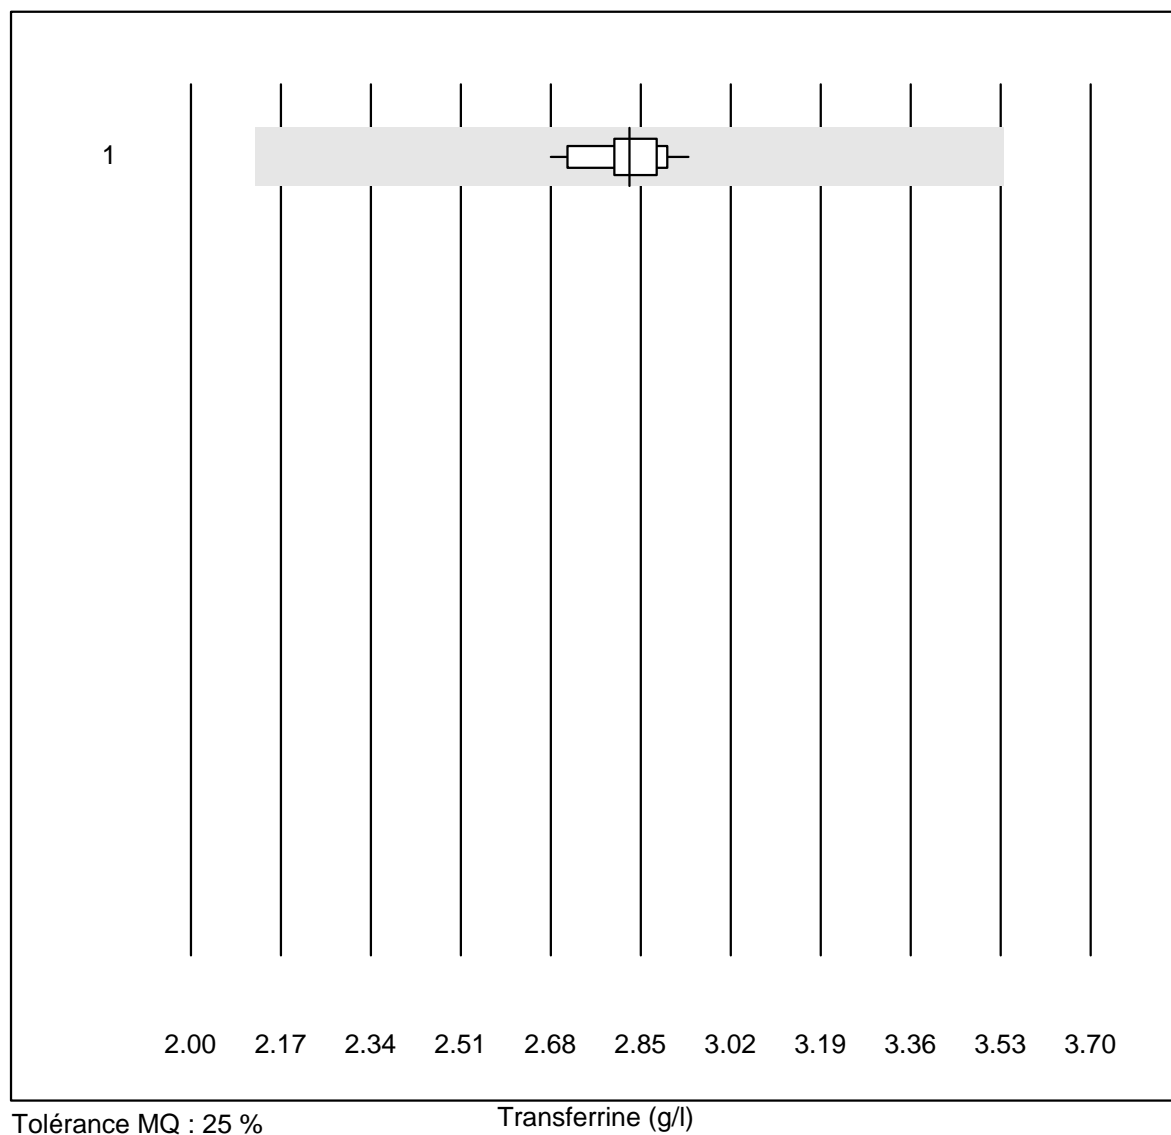

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	27	100.0	0.0	0.0	2.83	2.3	e

Bêta-2 microglobuline

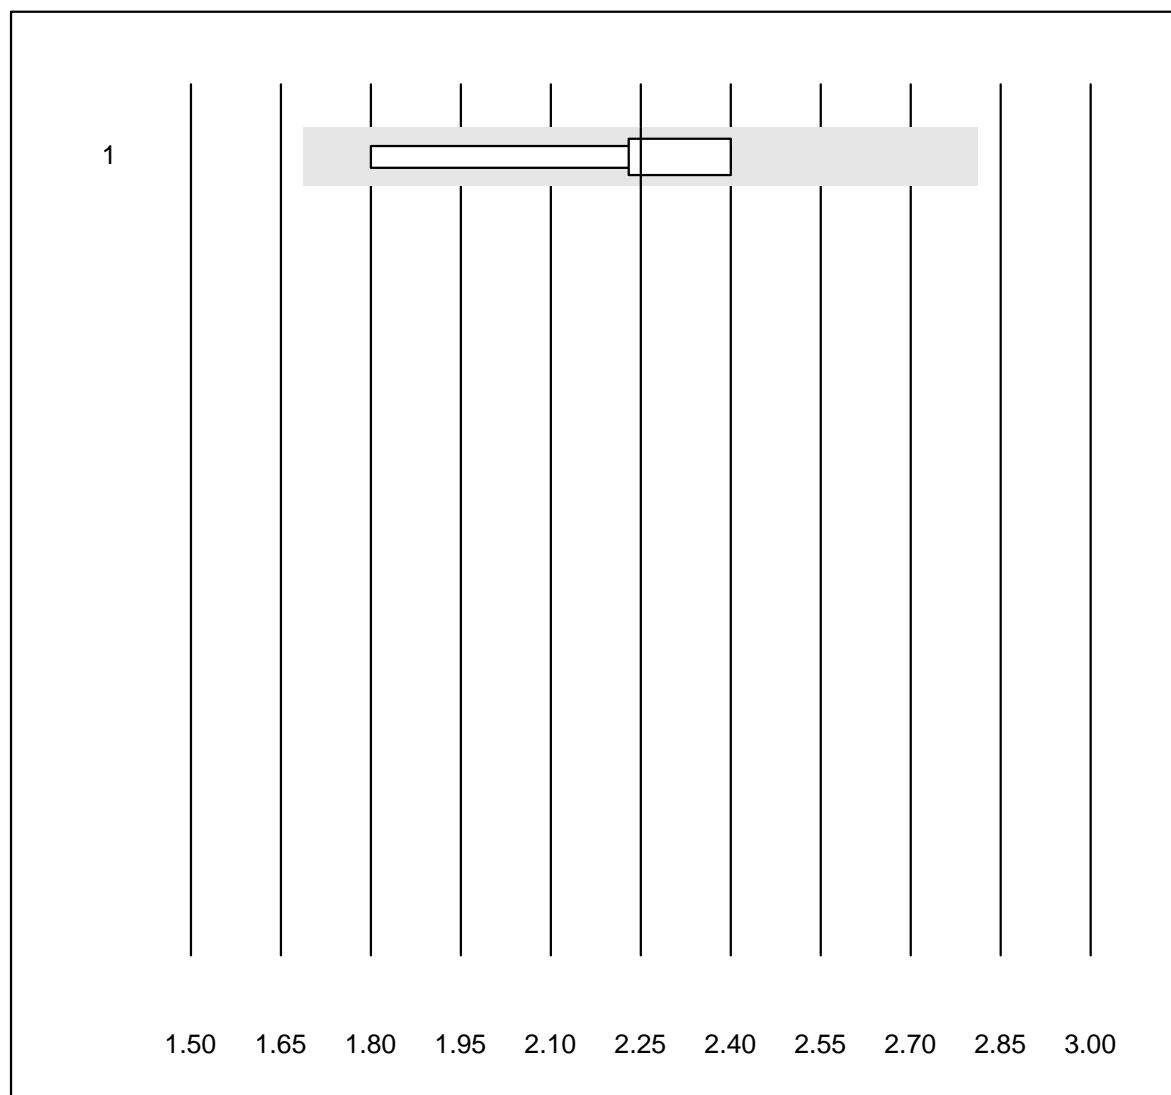


Tolérance MQ : 25 %

Bêta-2 microglobuline (mg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	2.25	9.9	e*

Facteur rhumatoïde

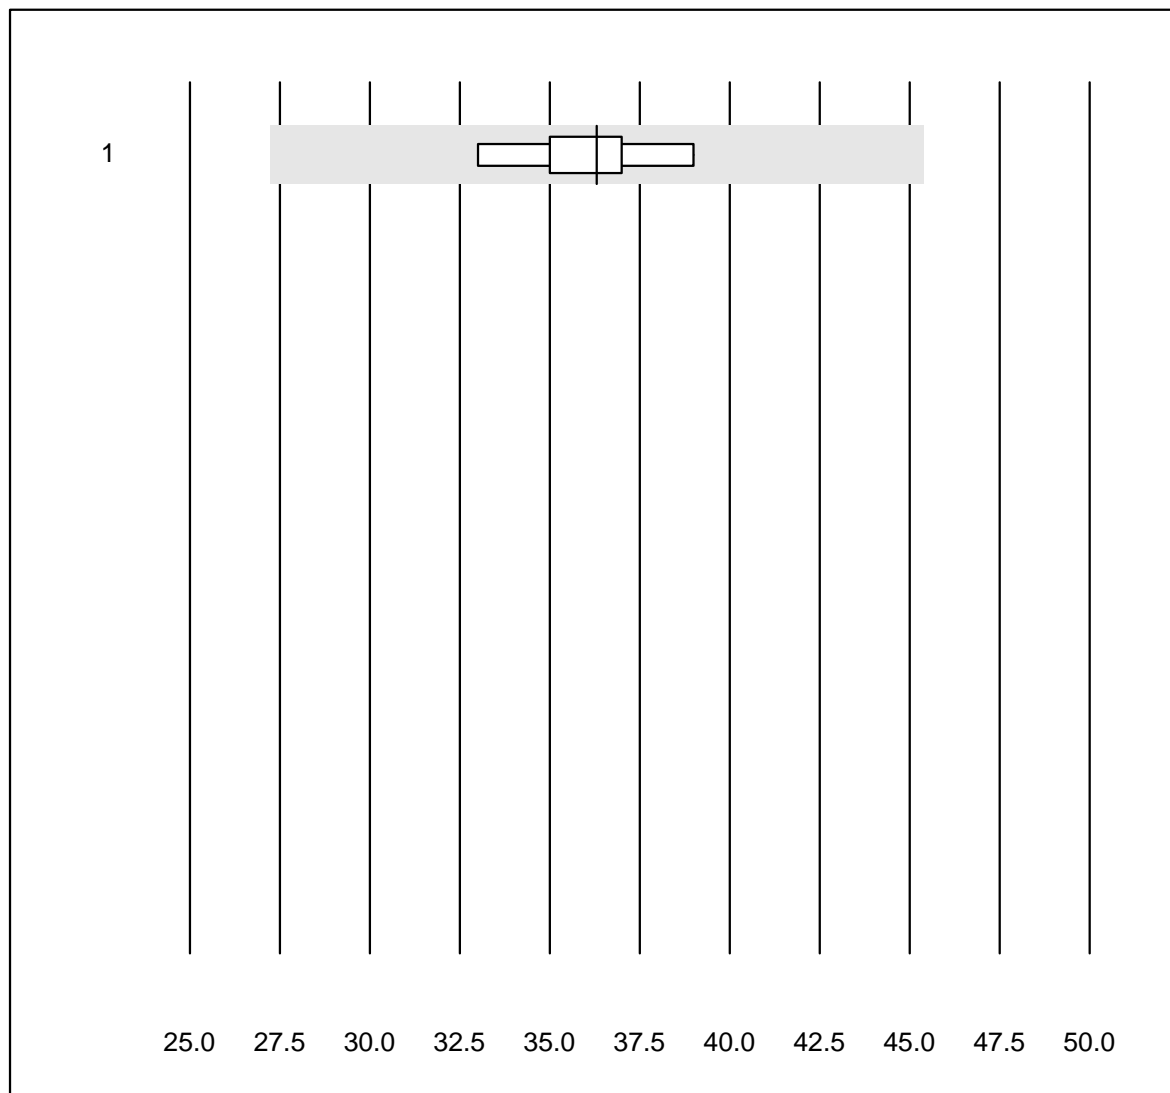


Tolérance MQ : 25 %

Facteur rhumatoïde (U/ml)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Architect	5	100.0	0.0	0.0	36.3	6.2	e

Céruleoplasmine

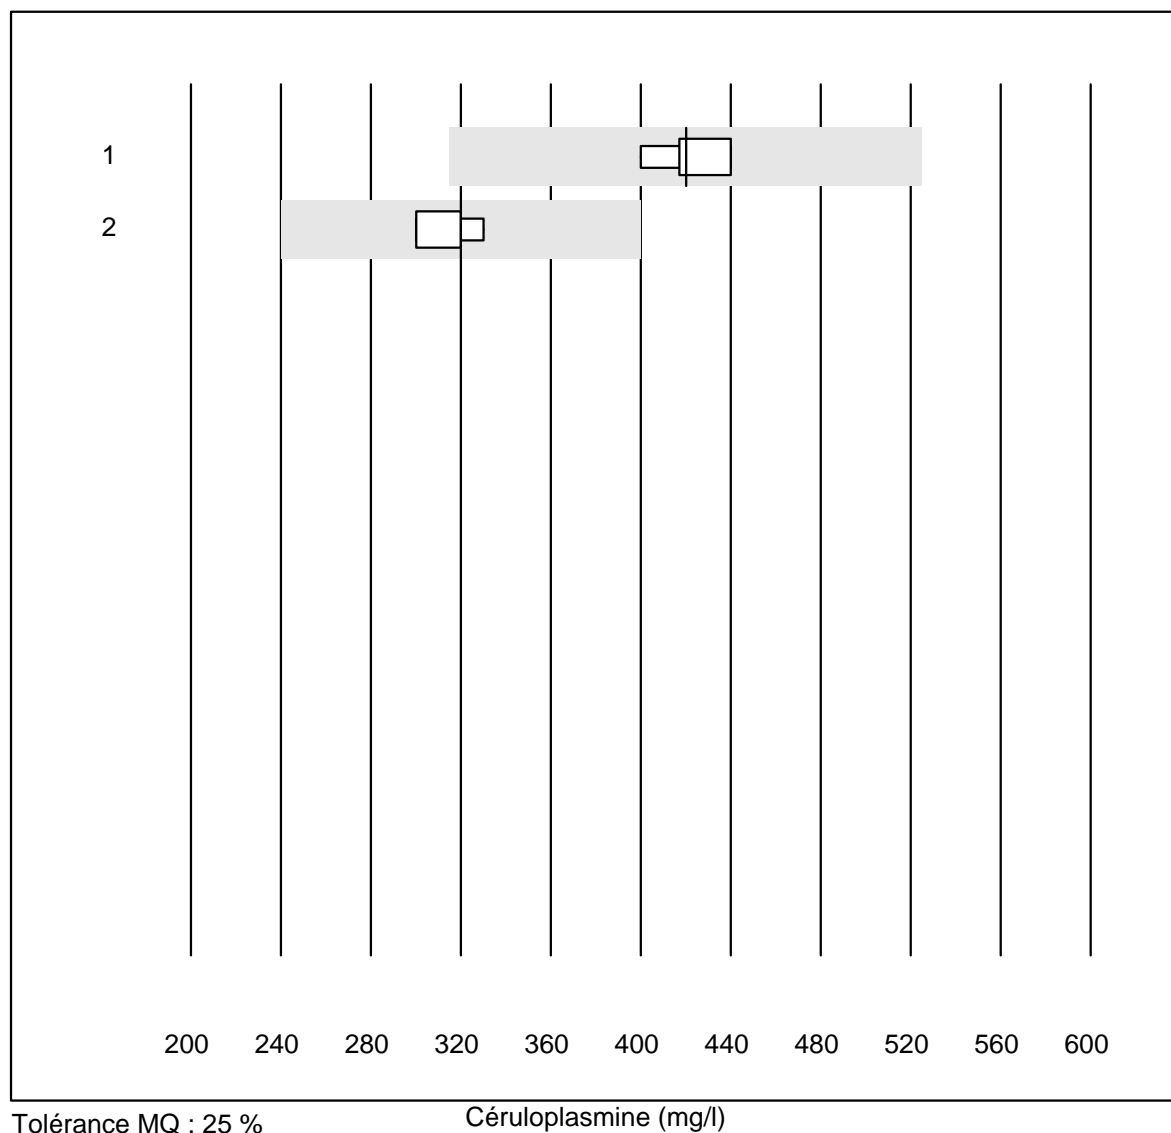


Tolérance MQ : 25 %

Céruleoplasmine (mg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Siemens	5	100.0	0.0	0.0	420.00	4.0	e
2 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	320.00	4.0	e

Pré-albumine

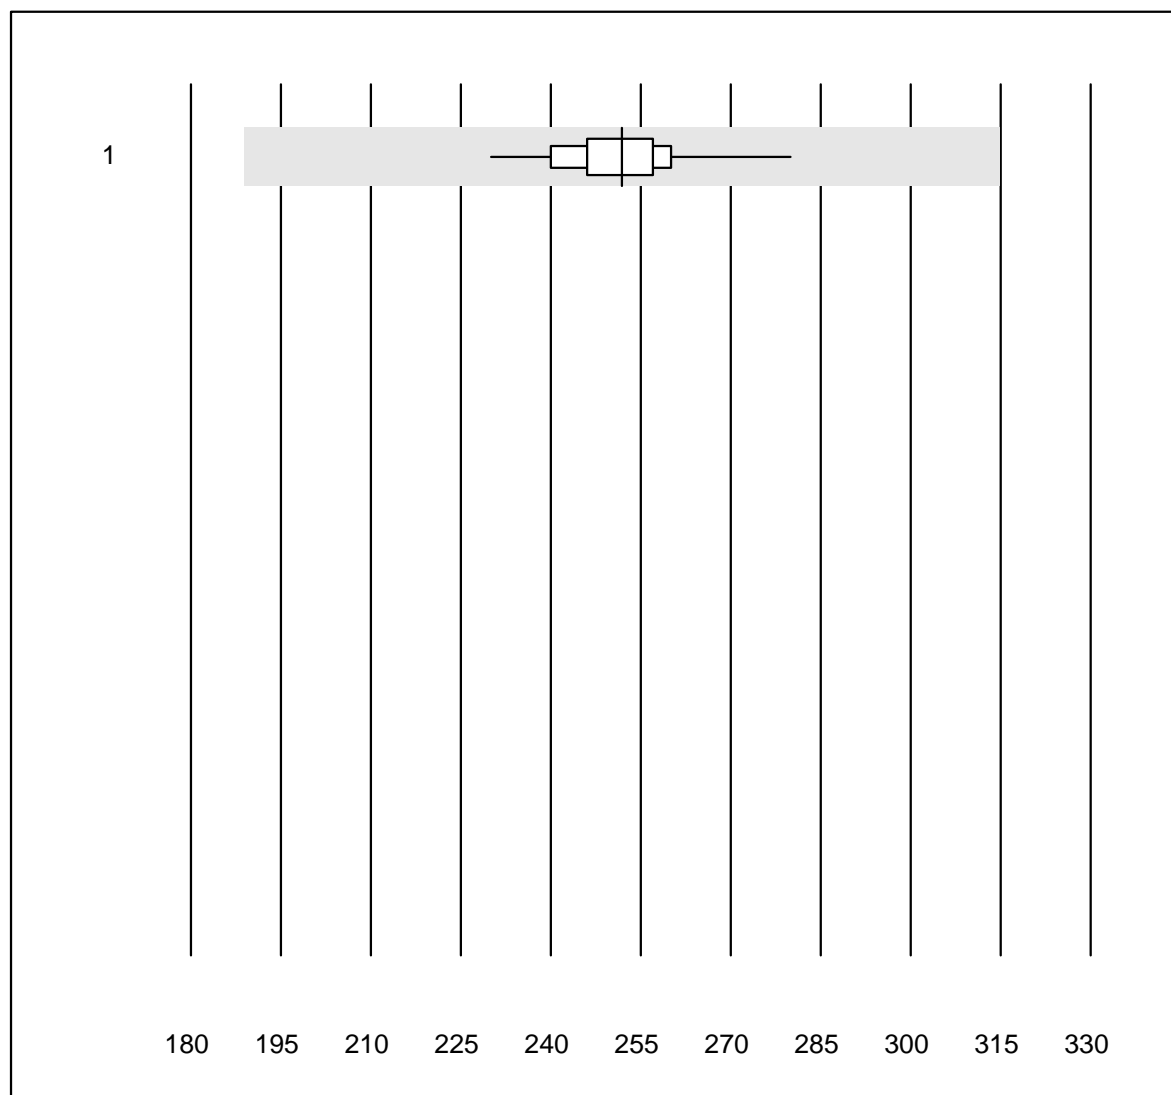


Tolérance MQ : 25 %

Pré-albumine (mg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	16	100.0	0.0	0.0	251.9	4.4	e

Récepteur soluble de la transferrine

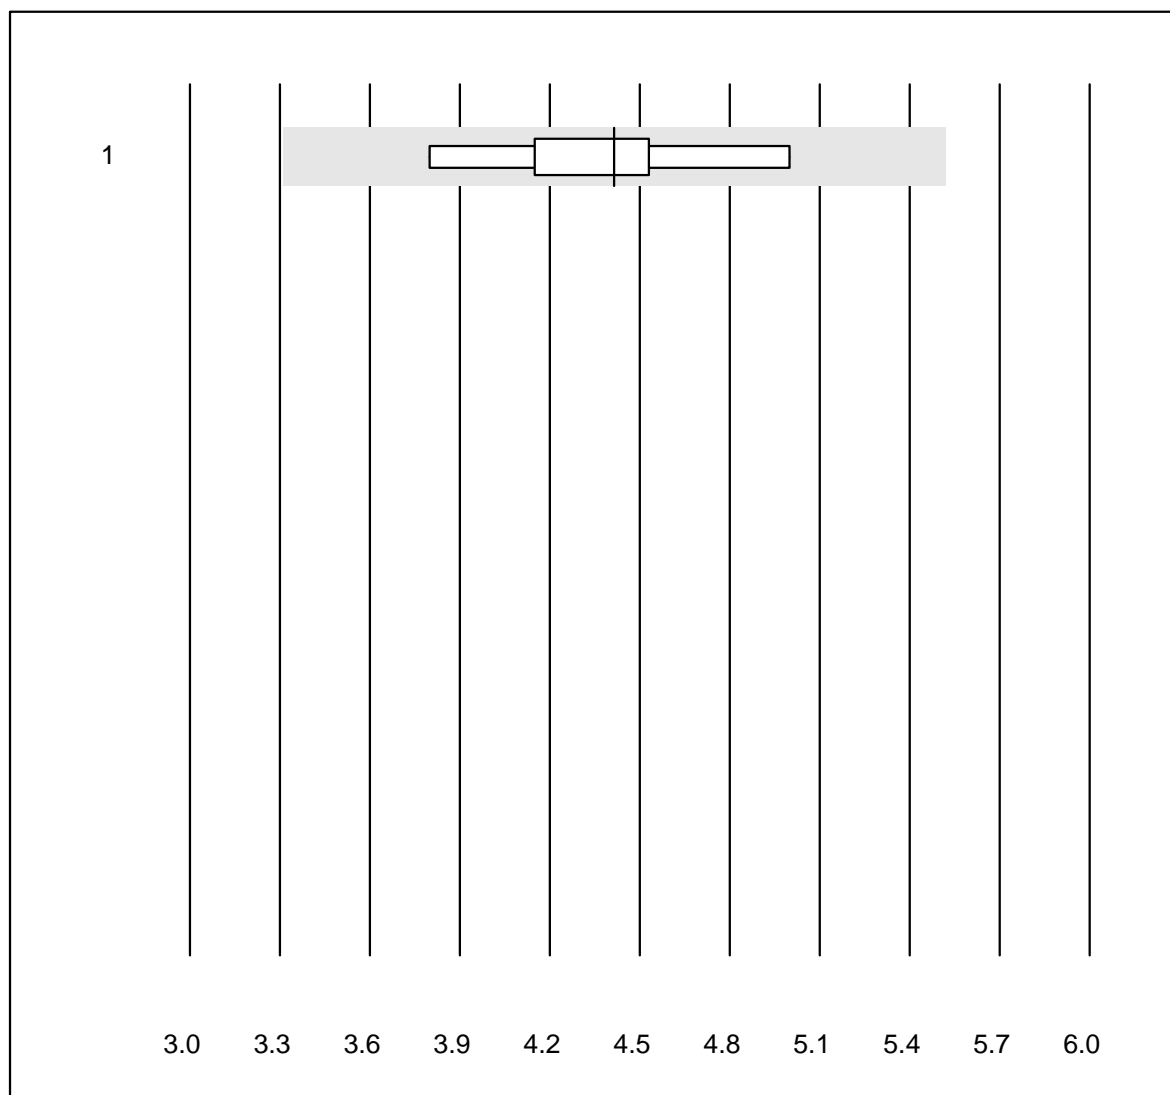


Tolérance MQ : 25 %

Récepteur soluble de la transferrine (mg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	8	100.0	0.0	0.0	4.4	8.3	e


chaînes légères libres Kappa

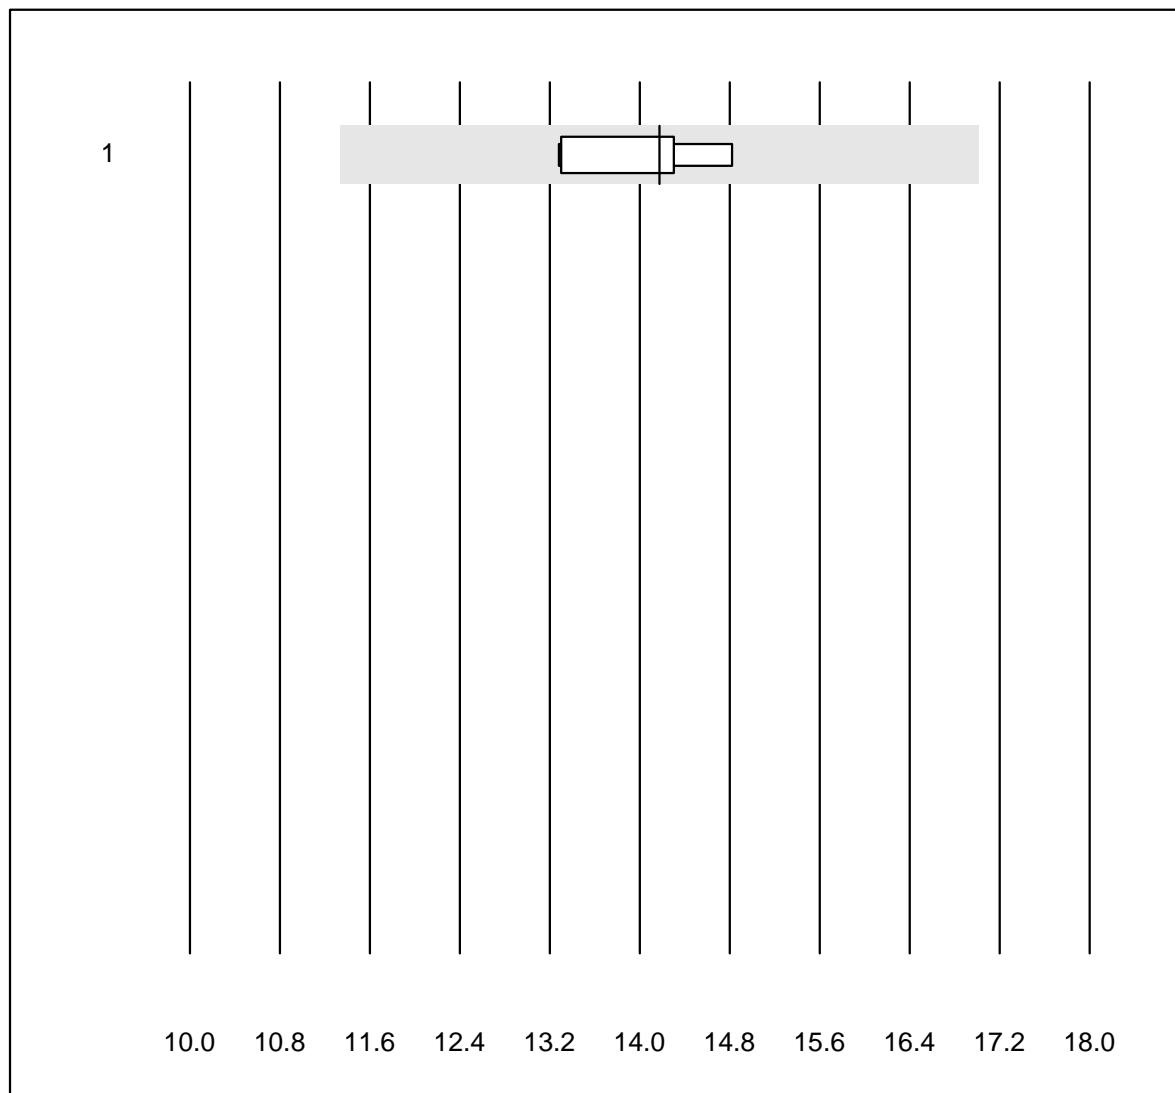

QUALAB Tolérance : 20 % chaînes légères libres Kappa (mg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	8	100.0	0.0	0.0	14	4.0	e

chaîne légère Lambda

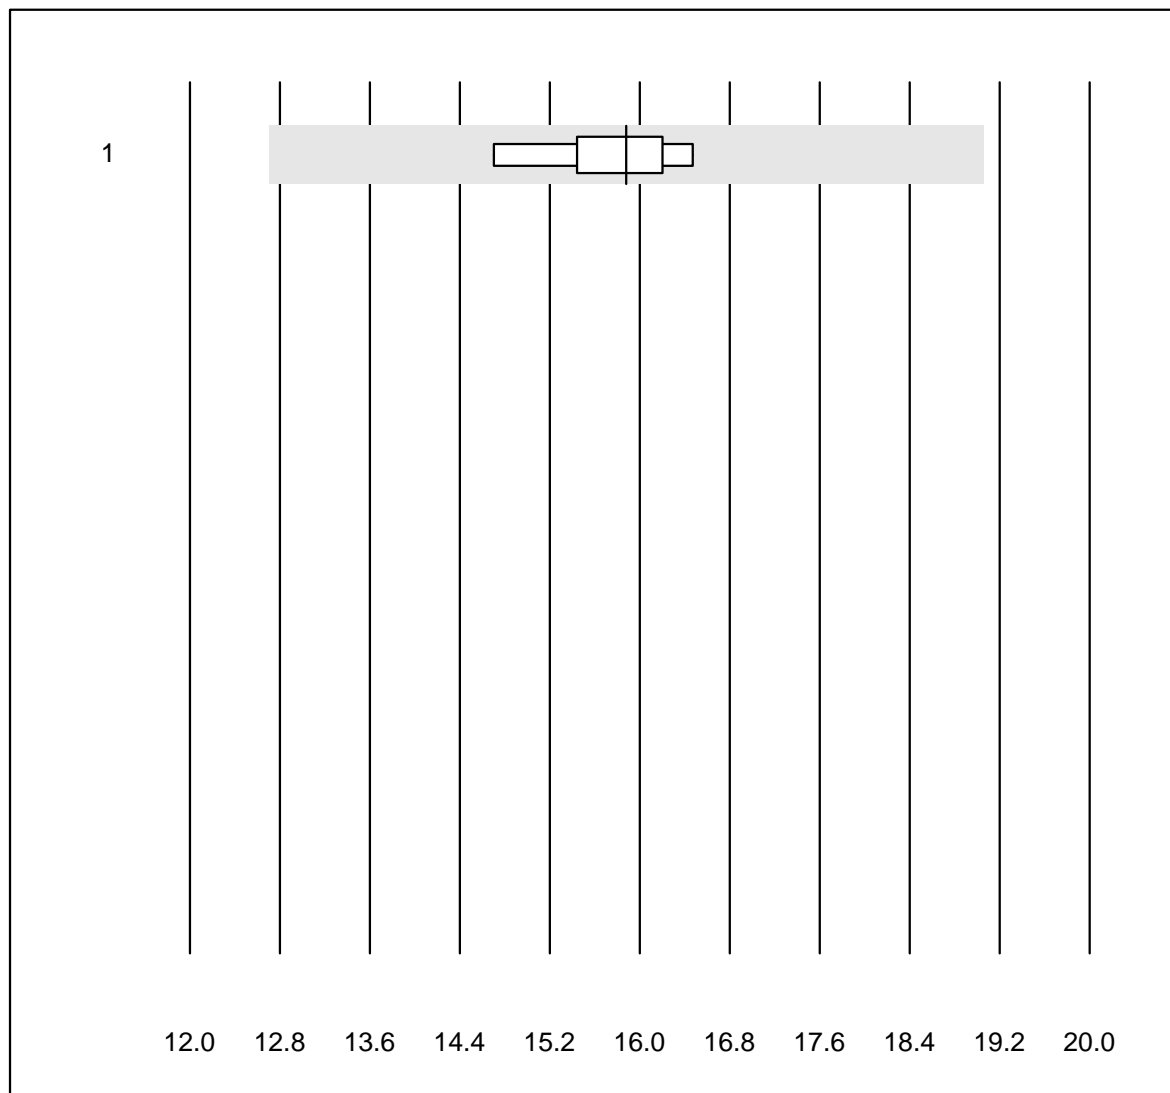


QUALAB Tolérance : 20 %

chaîne légère Lambda (mg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	8	100.0	0.0	0.0	16	3.6	e

CRP HS

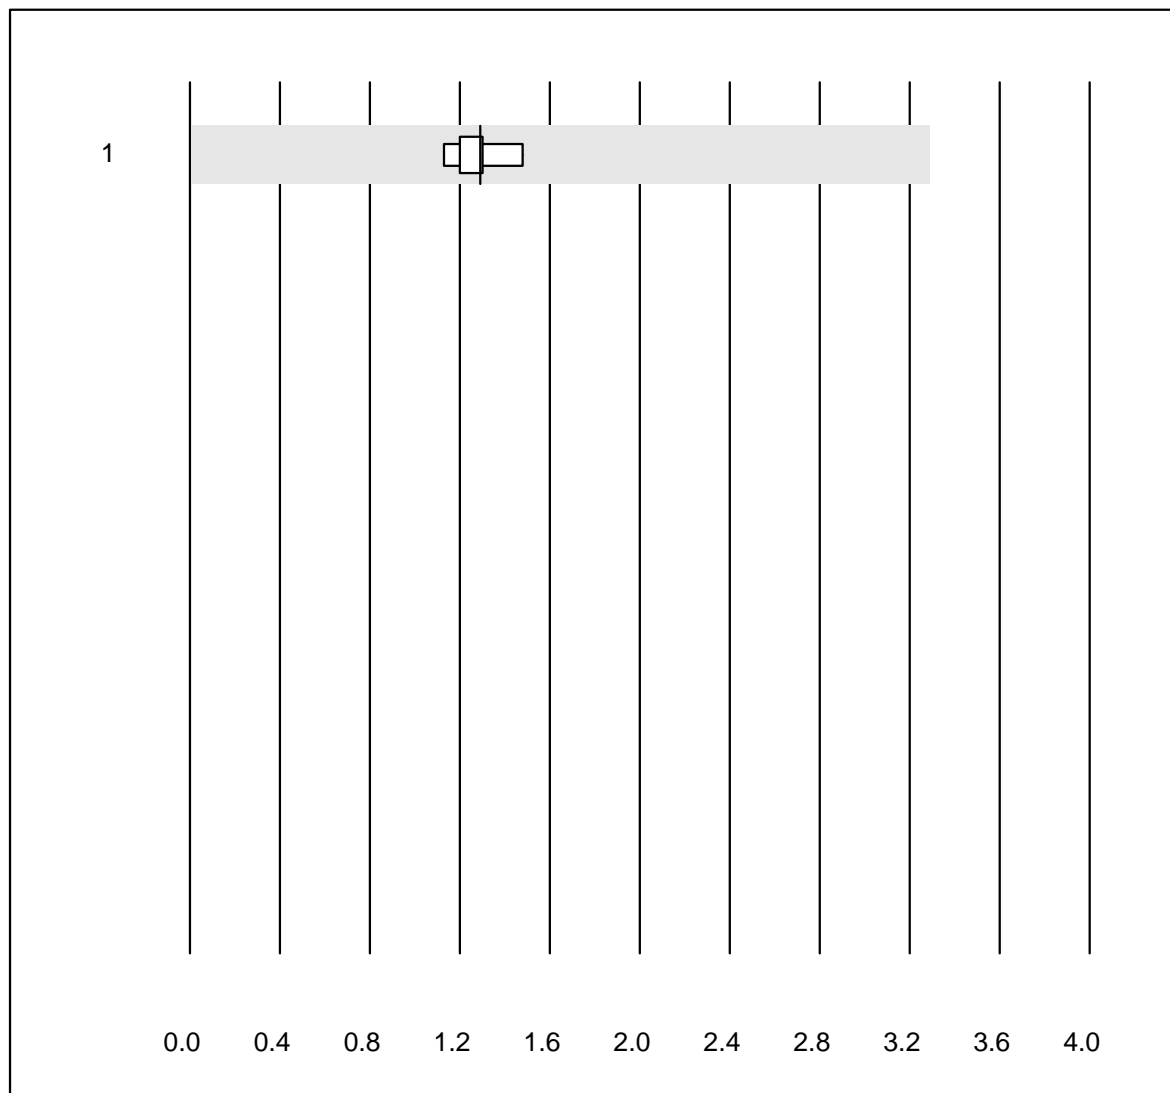


QUALAB Tolérance : 21 %
 (< 10.00: +/- 2.00 mg/l)

CRP HS (mg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Turbidimetrie	6	100.0	0.0	0.0	1.29	9.2	e*


CRP

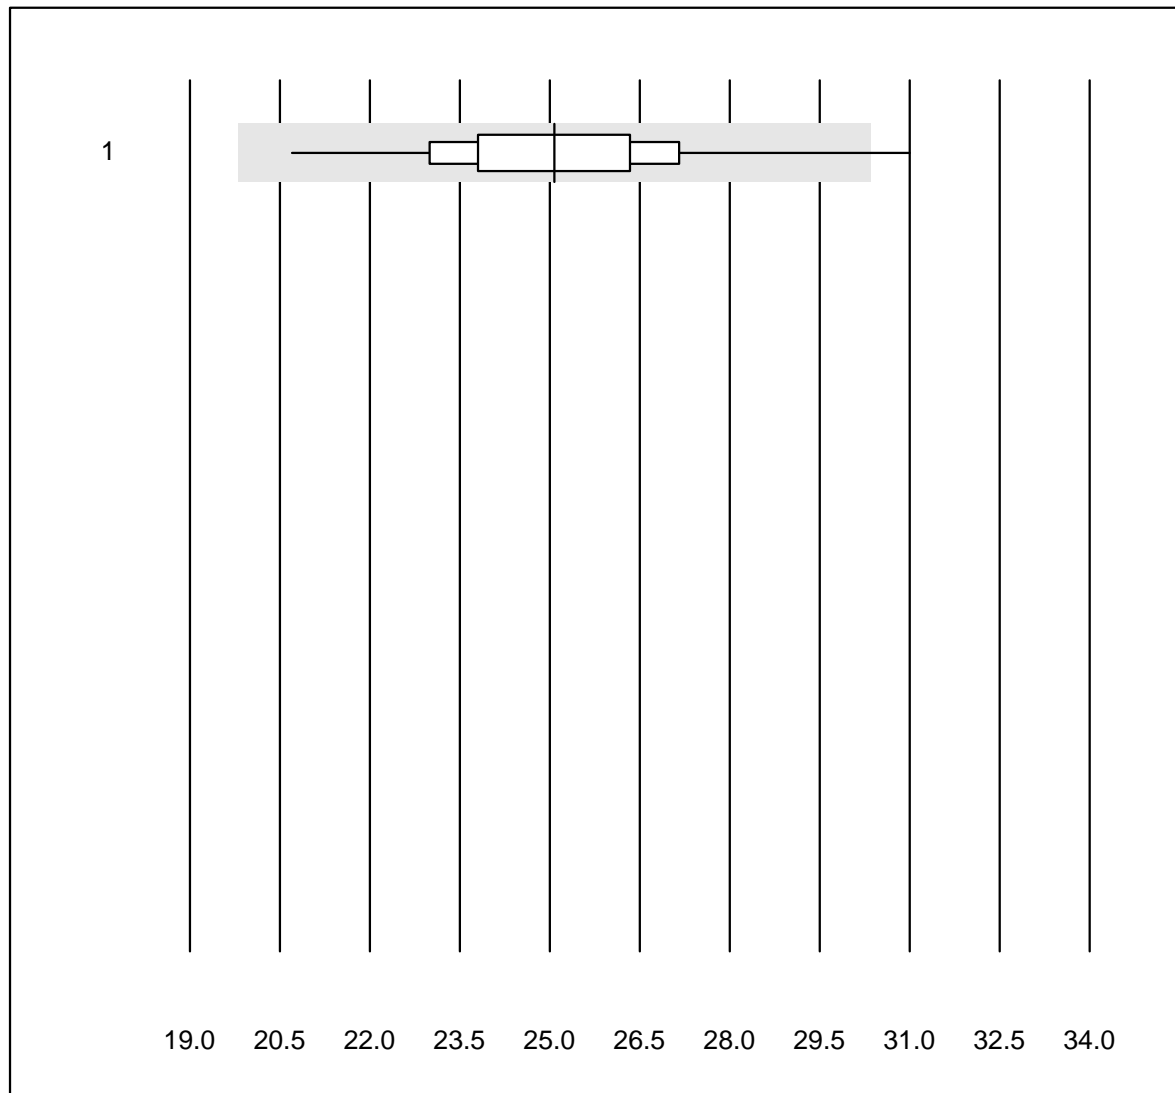

QUALAB Tolérance : 21 % CRP (mg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 AFIAS	128	96.1	0.8	3.1	25.1	7.7	e

Anti deam. Gliadin IgG

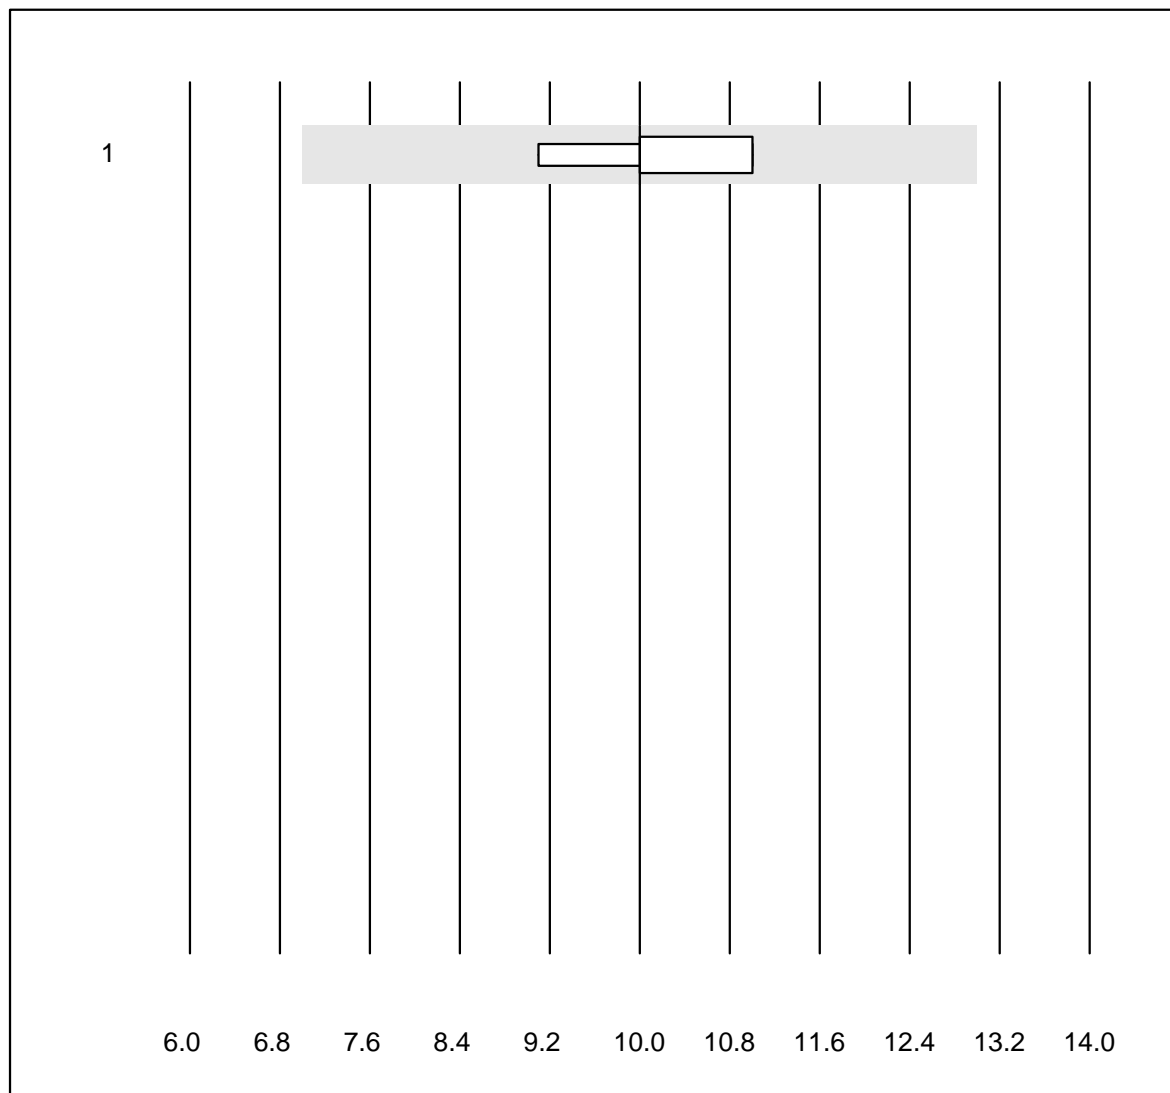


Tolérance MQ : 30 %

Anti deam. Gliadin IgG (U/ml)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Autres méthodes	6	100.0	0.0	0.0	10.00	7.1	e

Anti deam. Gliadin IgA

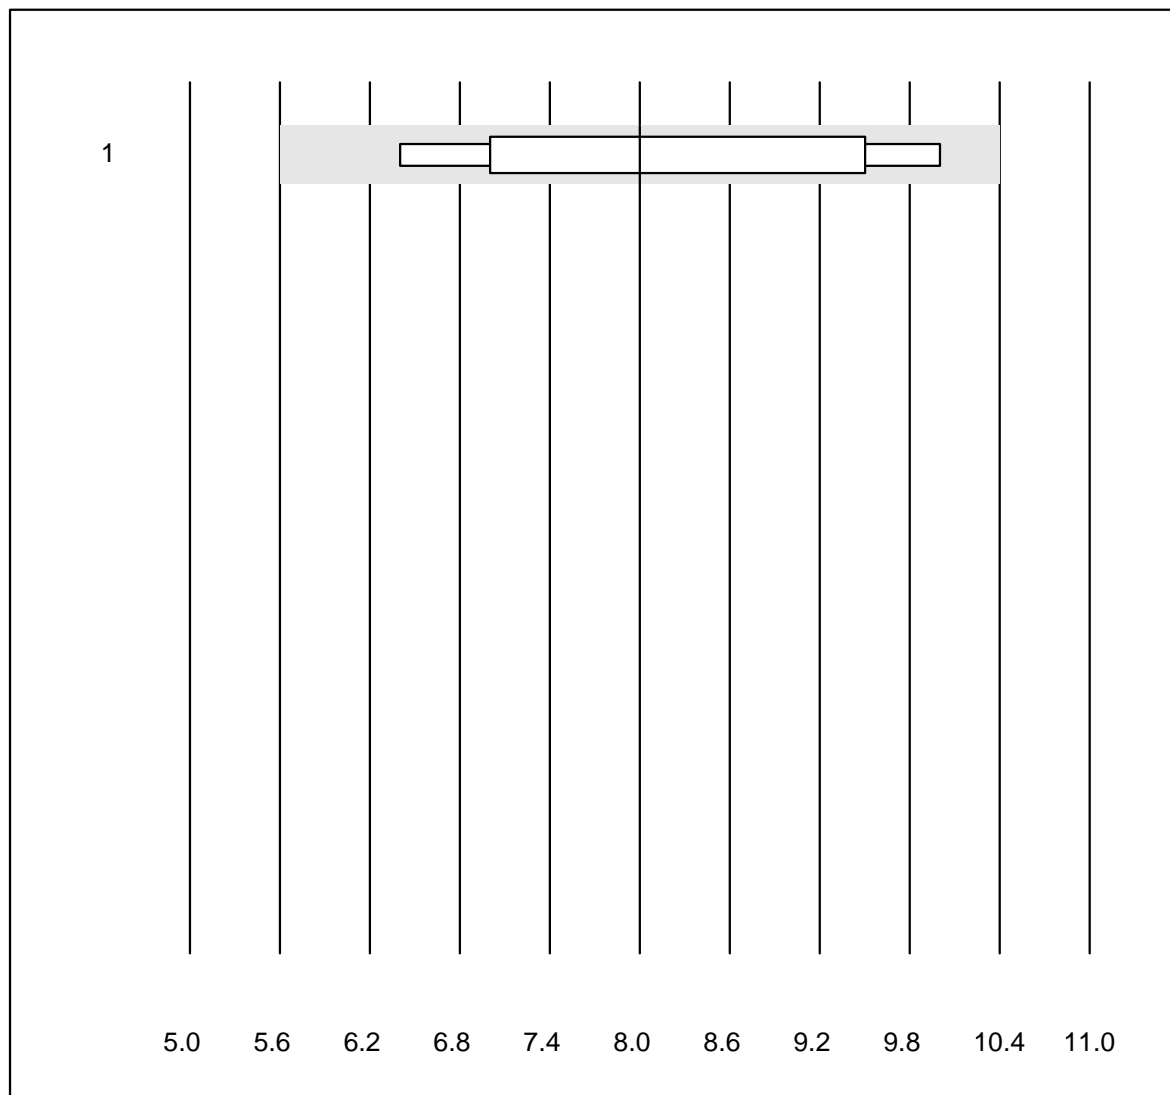


Tolérance MQ : 30 %

Anti deam. Gliadin IgA (U/ml)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Autres méthodes	6	100.0	0.0	0.0	8.00	17.1	e*

Anti tTG IgG

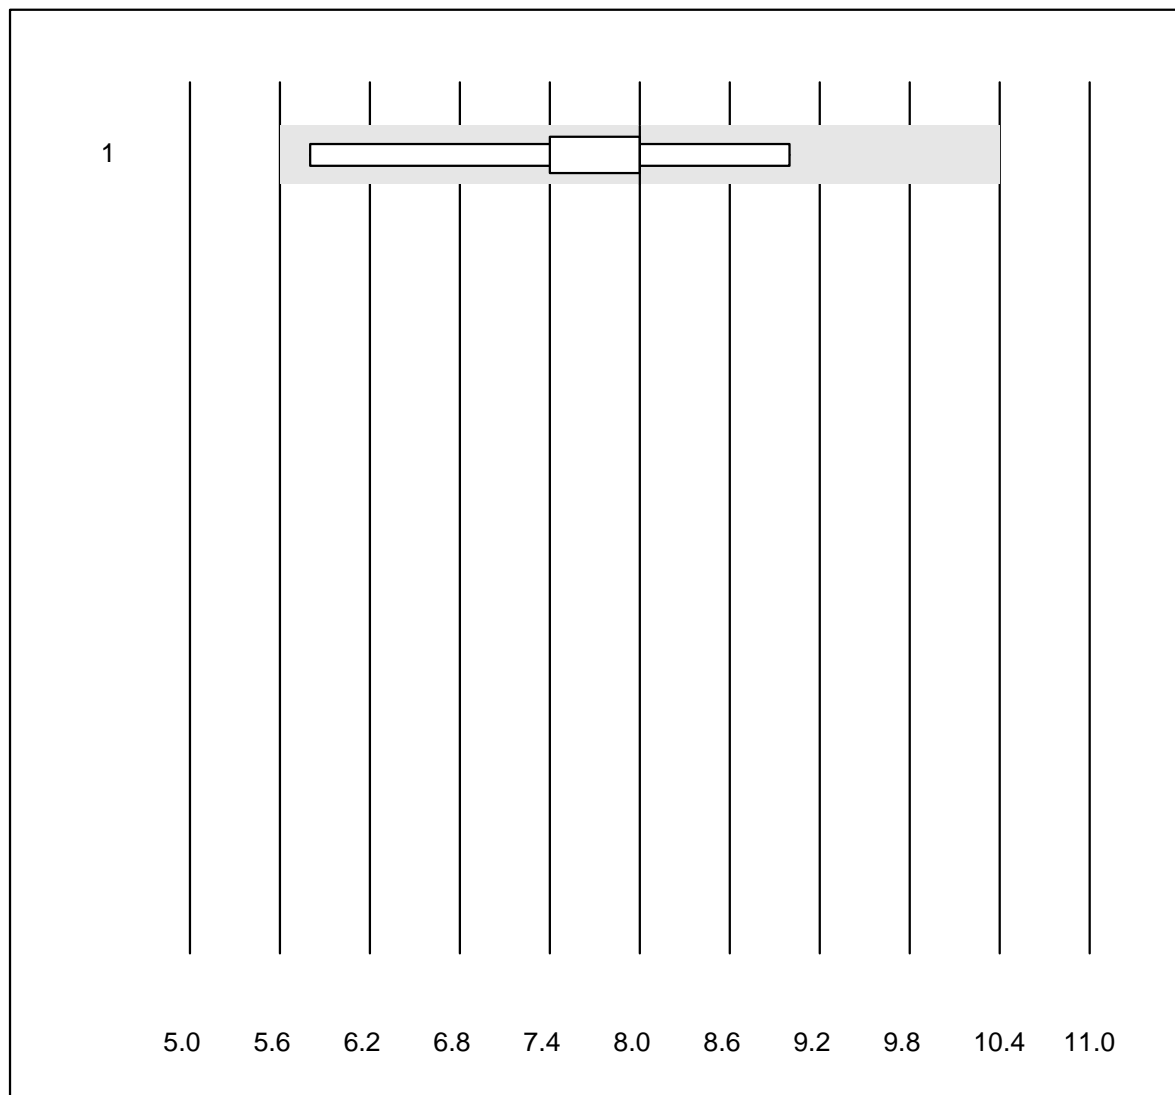


Tolérance MQ : 30 %

Anti tTG IgG (U/ml)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Autres méthodes	5	100.0	0.0	0.0	8.00	15.4	e*

Anti tTG IgA

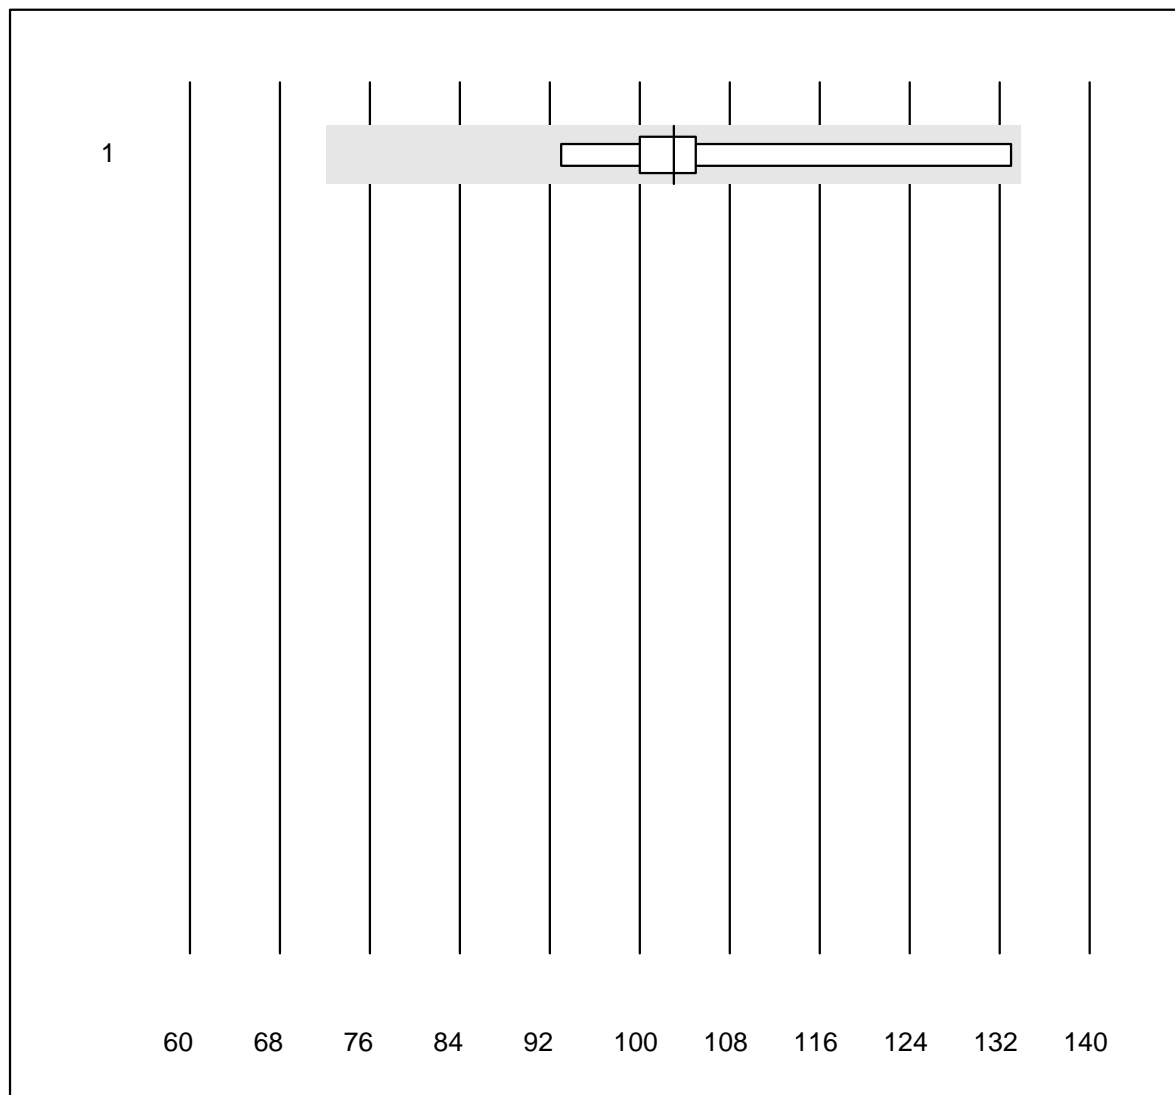


Tolérance MQ : 30 %

Anti tTG IgA (U/ml)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Autres méthodes	6	100.0	0.0	0.0	103.00	13.1	e*

Albumine

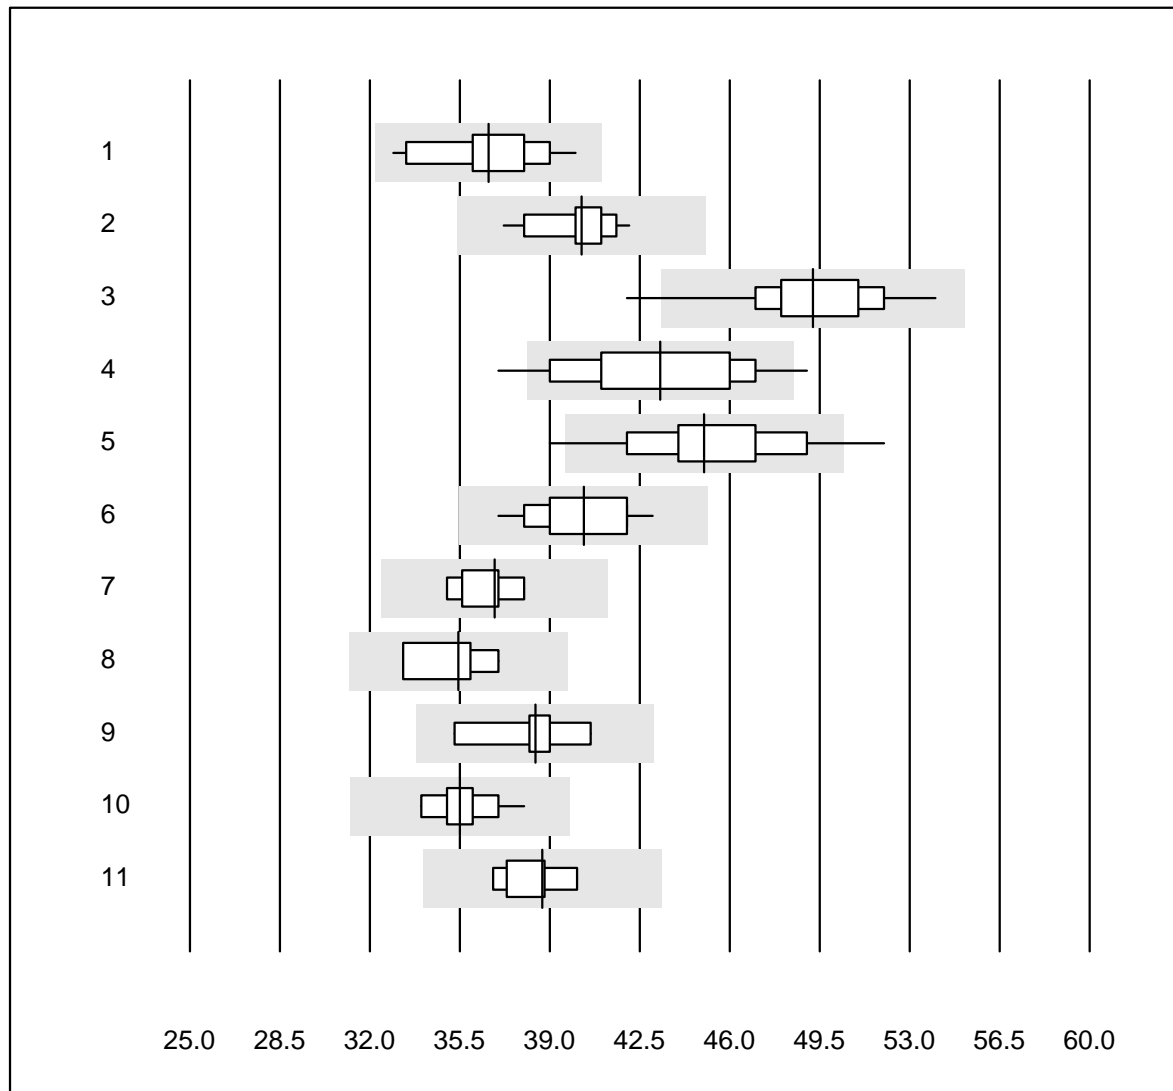


QUALAB Tolérance : 12 %

Albumine (g/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1	Chimie humide	14	100.0	0.0	0.0	37	5.5	e*
2	Cobas	21	100.0	0.0	0.0	40	3.4	e
3	Fuji Dri-Chem	229	98.7	0.9	0.4	49	4.4	e
4	Spotchem/Ready	26	92.3	7.7	0.0	43	6.7	e
5	Spotchem D-Concept	173	96.5	2.9	0.6	45	5.7	e
6	Piccolo	57	100.0	0.0	0.0	40	4.0	e
7	Beckmann	8	100.0	0.0	0.0	37	2.5	e
8	Dimension	4	100.0	0.0	0.0	35	4.4	e*
9	Abx Mira	6	100.0	0.0	0.0	38	4.5	e*
10	Hitachi S40/M40	10	100.0	0.0	0.0	36	3.6	e
11	Autolyser/DiaSys	7	85.7	0.0	14.3	39	3.1	e

Phosphatase alcaline

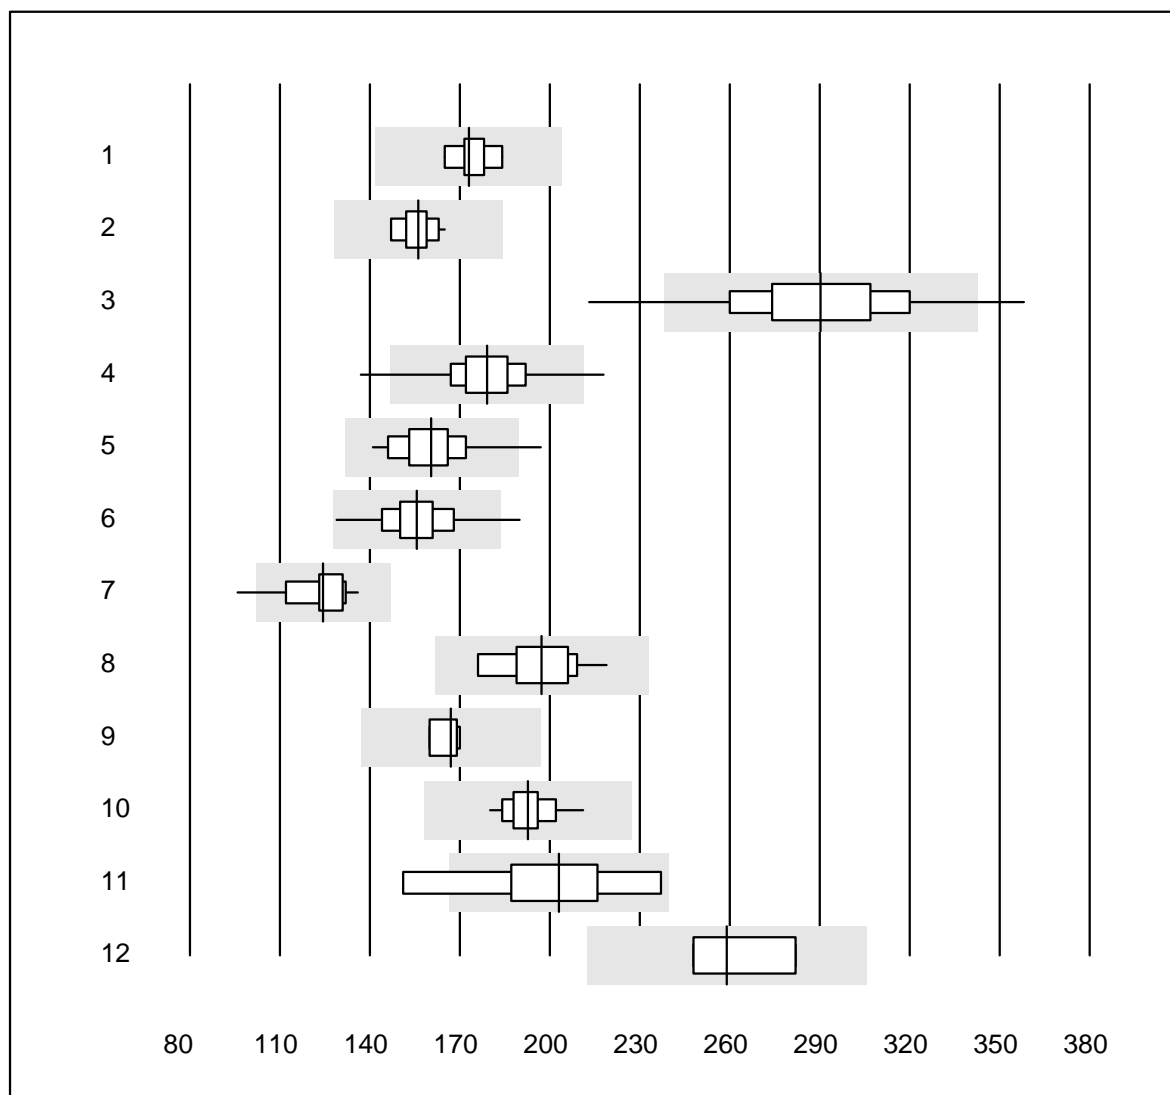


QUALAB Tolérance : 18 %

Phosphatase alcaline (U/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 IFCC	9	100.0	0.0	0.0	173	3.5	e
2 Cobas	22	100.0	0.0	0.0	156	3.4	e
3 Reflotron	429	94.8	4.0	1.2	290	8.5	e
4 Fuji Dri-Chem	837	98.9	0.5	0.6	179	5.7	e
5 Spotchem/Ready	50	98.0	2.0	0.0	161	6.8	e
6 Spotchem D-Concept	329	98.2	0.9	0.9	156	6.0	e
7 Hitachi S40/M40	15	86.6	6.7	6.7	124	8.2	e
8 Beckman	10	100.0	0.0	0.0	197	6.5	e
9 Dimension	4	100.0	0.0	0.0	167	2.7	e
10 Piccolo	47	97.9	0.0	2.1	193	3.8	e
11 Abx Mira	8	87.5	12.5	0.0	203	12.9	e*
12 Skyla	4	75.0	0.0	25.0	259	6.5	e*
13 Autolyser/DiaSys	17	100.0	0.0	0.0	157	3.8	e
14 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	166	2.5	e

Amylase

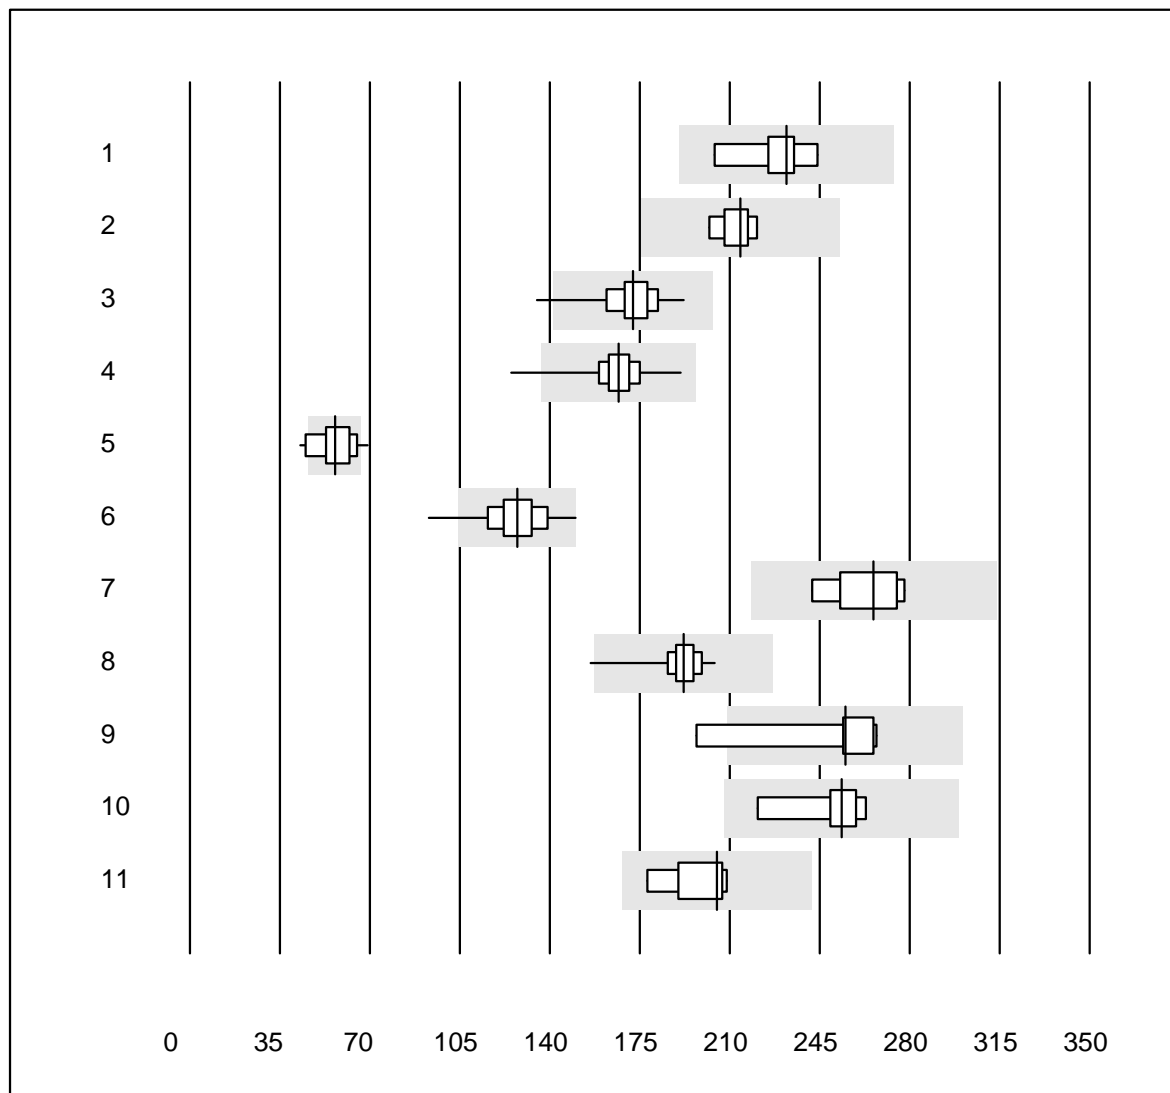


QUALAB Tolérance : 18 %

Amylase (U/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 IFCC	7	100.0	0.0	0.0	232	5.4	e
2 Cobas	9	100.0	0.0	0.0	214	3.1	e
3 Reflotron	106	97.2	1.9	0.9	172	5.1	e
4 Fuji Dri-Chem	613	99.4	0.3	0.3	167	4.2	e
5 Spotchem/Ready	43	55.8	11.6	32.6	56	12.3	e
6 Spotchem D-Concept	257	96.5	1.2	2.3	127	7.1	e
7 Architect	5	100.0	0.0	0.0	266	5.8	e*
8 Piccolo	49	98.0	2.0	0.0	192	3.7	e
9 Abx Mira	5	80.0	20.0	0.0	255	11.7	e*
10 Hitachi S40/M40	6	100.0	0.0	0.0	254	6.0	e*
11 Autolyser/DiaSys	6	100.0	0.0	0.0	205	6.2	e*

Amylase pancréatique

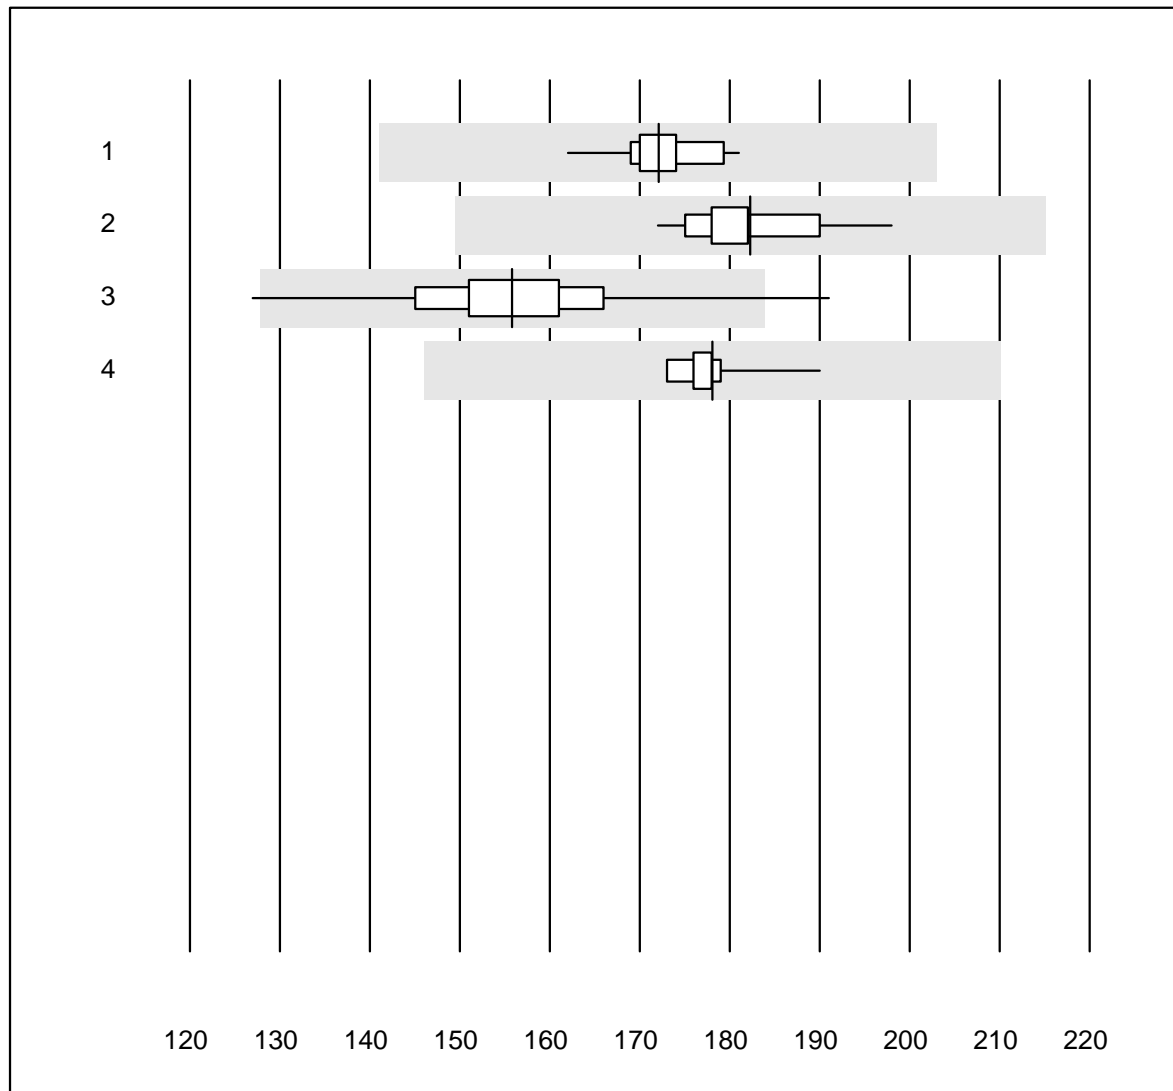


QUALAB Tolérance : 18 %

Amylase pancréatique (U/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 IFCC	15	100.0	0.0	0.0	172	2.6	e
2 Cobas	13	100.0	0.0	0.0	182	3.7	e
3 Reflotron	298	97.7	1.0	1.3	156	5.5	e
4 Autolyser/DiaSys	10	100.0	0.0	0.0	178	2.5	e

Bilirubine totale

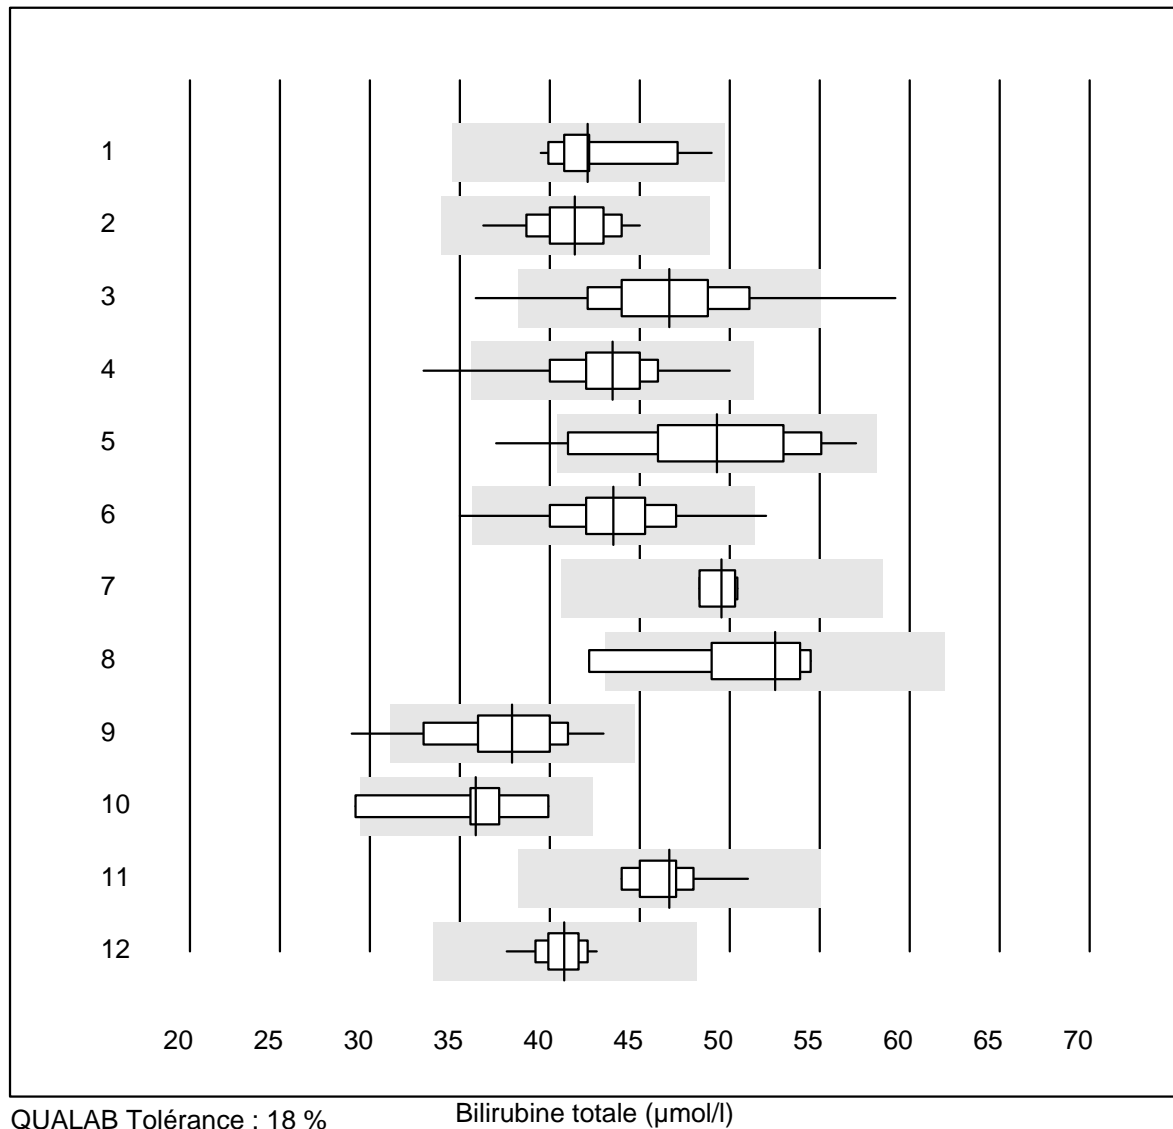

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Chimie humide	15	100.0	0.0	0.0	42.1	6.2	e
2 Cobas	20	100.0	0.0	0.0	41.4	5.2	e
3 Reflotron	323	94.4	3.4	2.2	46.6	7.9	e
4 Fuji Dri-Chem	678	98.4	0.7	0.9	43.5	5.7	e
5 Spotchem/Ready	49	87.7	8.2	4.1	49.3	10.4	e
6 Spotchem D-Concept	262	97.4	1.5	1.1	43.5	6.3	e
7 Dimension	4	100.0	0.0	0.0	49.6	2.1	e
8 Beckman	9	88.9	11.1	0.0	52.5	8.5	e*
9 Piccolo	56	94.6	5.4	0.0	37.9	8.1	e
10 Abx Mira	9	88.9	11.1	0.0	35.9	8.6	e*
11 Hitachi S40/M40	12	91.7	0.0	8.3	46.6	4.2	e
12 Autolyser/DiaSys	15	100.0	0.0	0.0	40.8	3.1	e

Bilirubine directe

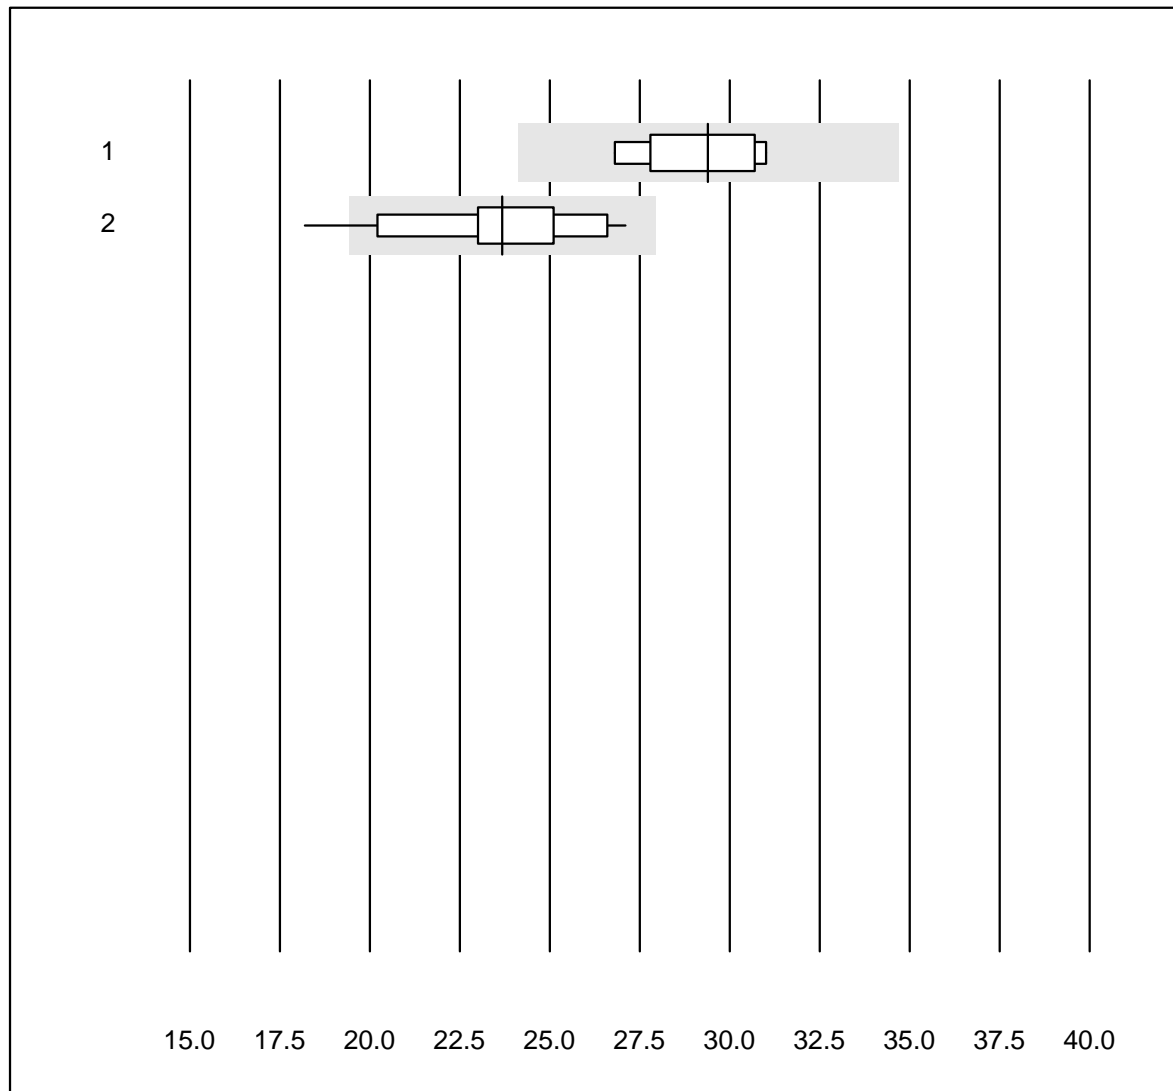


Tolérance MQ : 18 %

Bilirubine directe (µmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Autolyser/DiaSys	7	100.0	0.0	0.0	29.4	5.2	e
2 Fuji Dri-Chem	30	93.4	3.3	3.3	23.7	8.9	e

Calcium

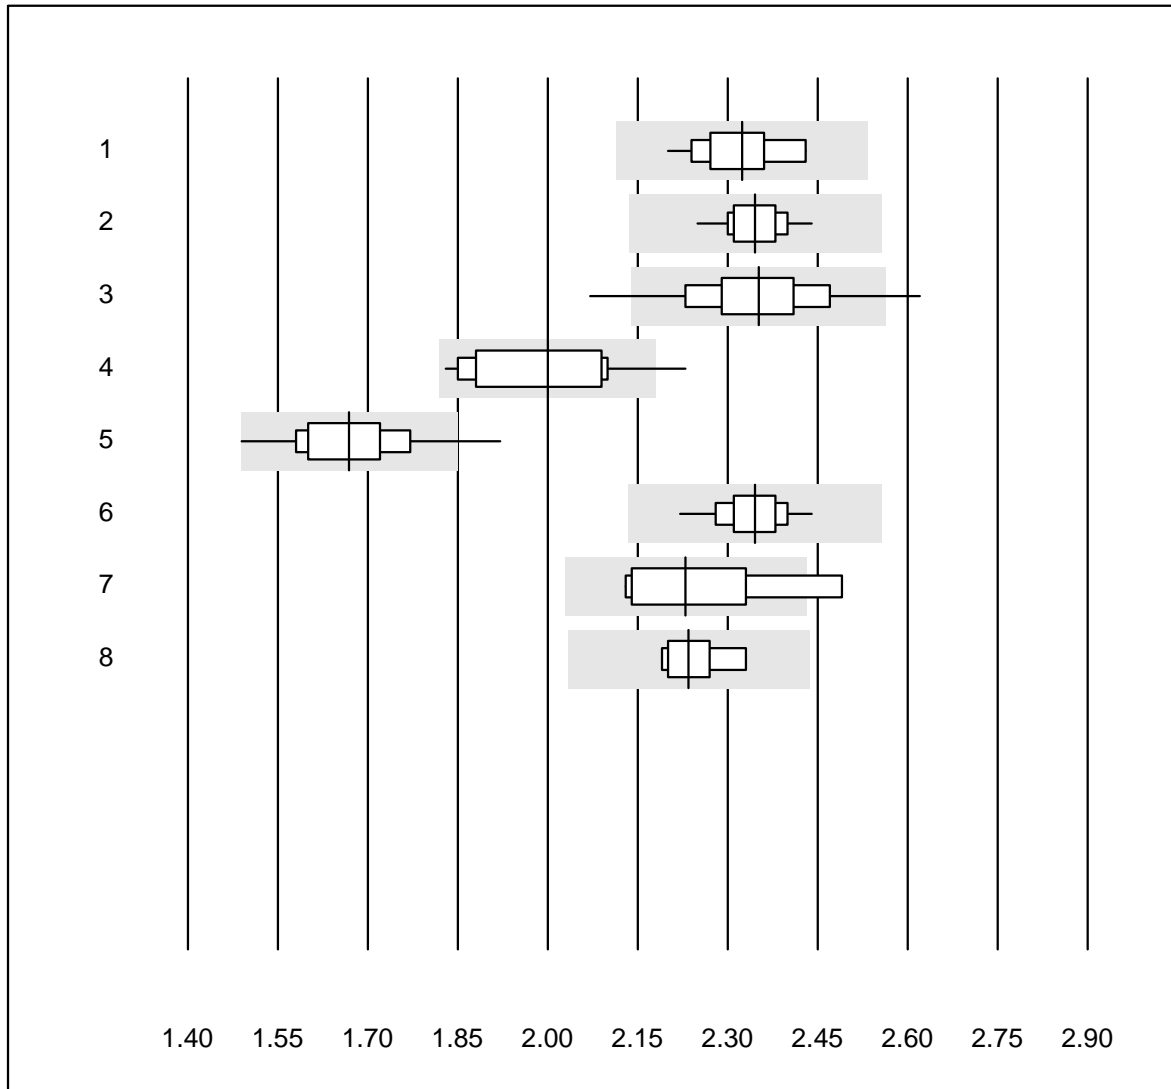


QUALAB Tolérance : 9 %
(< 2.00: +/- 0.18 mmol/l)

Calcium (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1	Chimie humide	28	100.0	0.0	0.0	2.32	2.9	e
2	Cobas	22	100.0	0.0	0.0	2.35	1.9	e
3	Fuji Dri-Chem	342	94.5	2.9	2.6	2.35	4.0	e
4	Spotchem/Ready	14	71.5	7.1	21.4	2.00	6.2	e*
5	Spotchem D-Concept	87	89.7	3.4	6.9	1.67	5.3	e
6	Piccolo	50	100.0	0.0	0.0	2.35	2.0	e
7	Hitachi S40/M40	9	88.9	11.1	0.0	2.23	5.4	e*
8	Autolyser/DiaSys	8	100.0	0.0	0.0	2.24	2.2	e

Calcium ISE

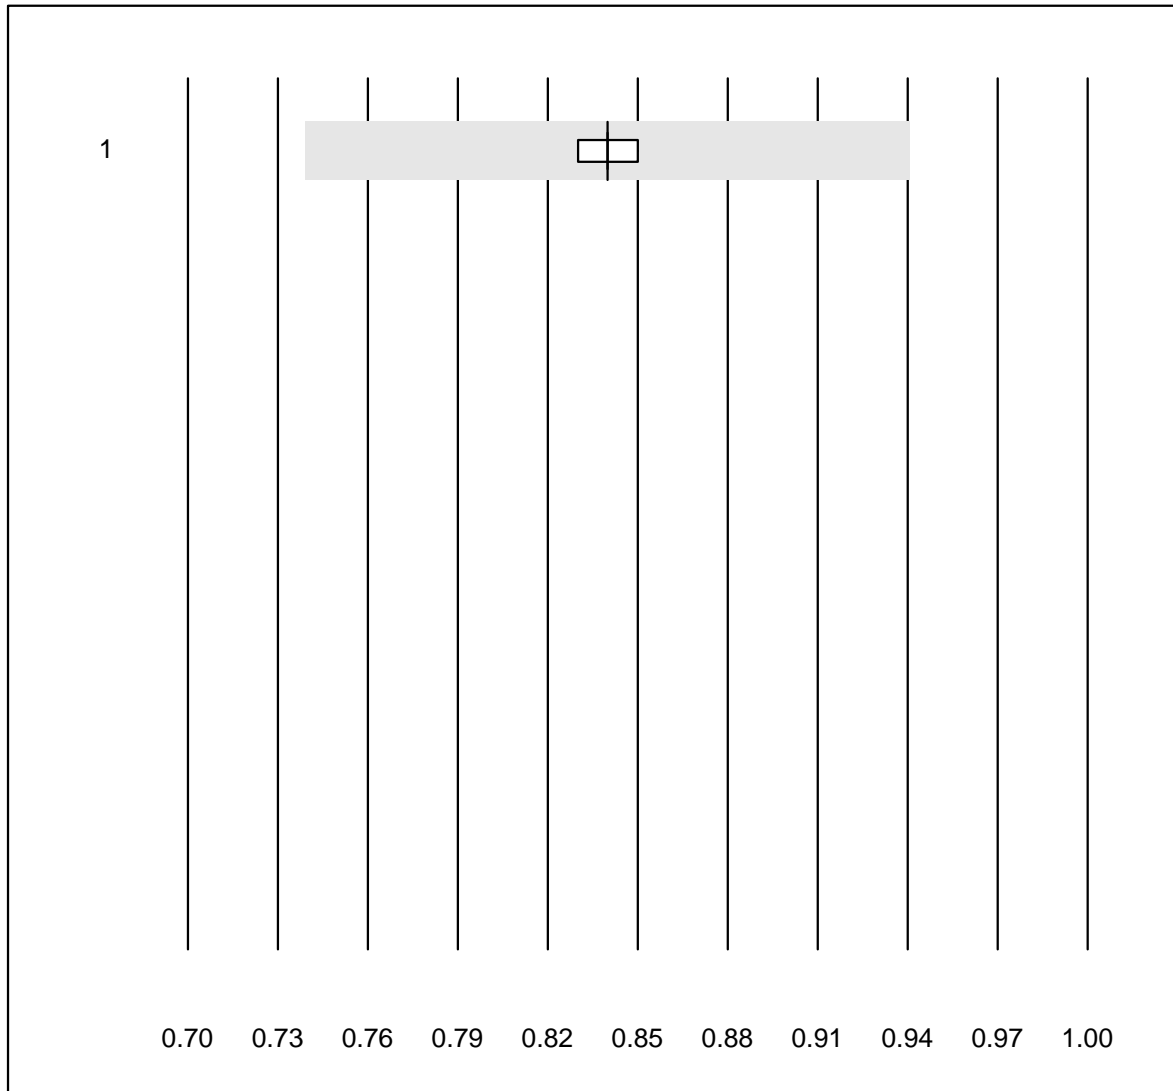


Tolérance MQ : 12 %

Calcium ISE (mmol/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 iStat Chem8	5	100.0	0.0	0.0	0.84	0.8	e

Chlorures

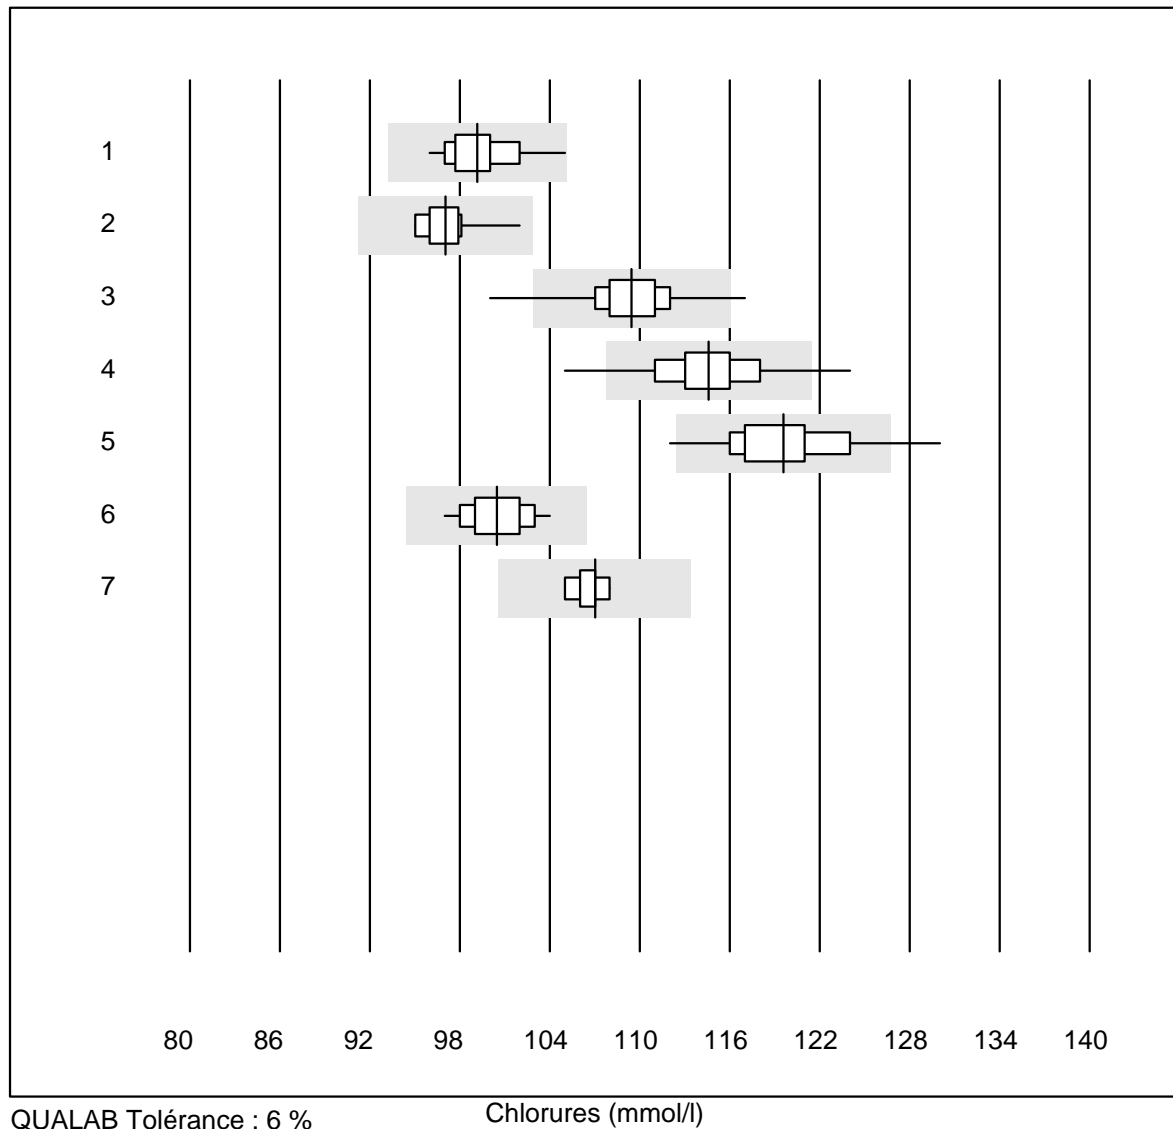

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 ISE	28	100.0	0.0	0.0	99	2.0	e
2 Cobas	12	91.7	0.0	8.3	97	2.0	e
3 Fuji Dri-Chem	767	97.8	1.8	0.4	109	2.1	e
4 Spotchem D-Concept	301	96.4	2.3	1.3	115	2.5	e
5 Spotchem EL-SE 1520	58	89.7	6.9	3.4	120	2.9	e
6 Piccolo	22	100.0	0.0	0.0	100	2.0	e
7 iStat Chem8	5	100.0	0.0	0.0	107	1.1	e

Cholestérol

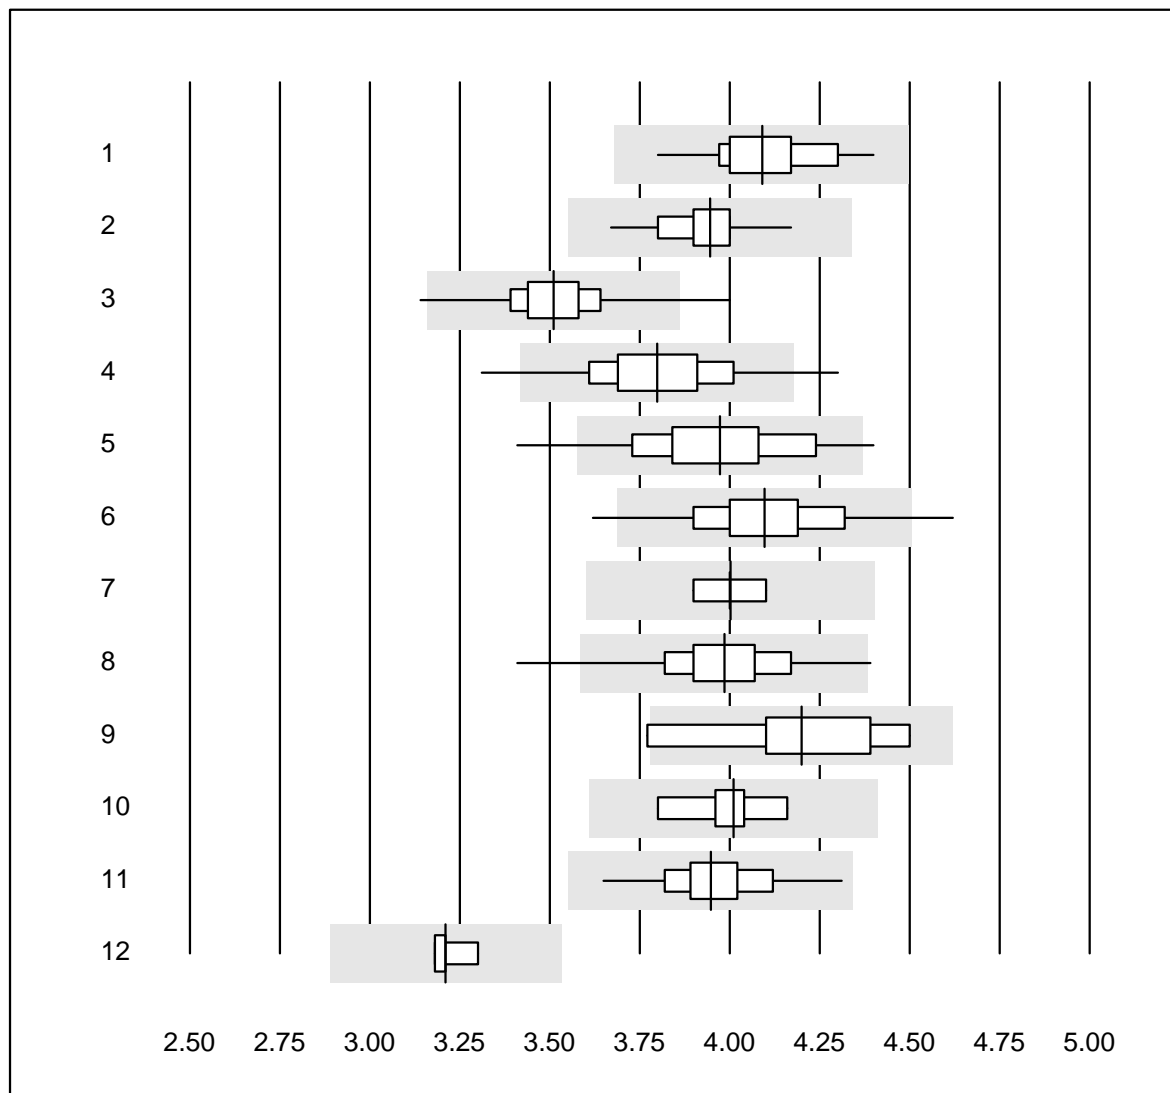


QUALAB Tolérance : 10 %

Cholestérol (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Chimie humide	27	96.3	0.0	3.7	4.09	3.3	e
2 Cobas	20	100.0	0.0	0.0	3.94	2.6	e
3 Reflotron	337	98.5	0.9	0.6	3.51	3.1	e
4 Fuji Dri-Chem	819	97.6	1.5	0.9	3.80	4.2	e
5 Spotchem/Ready	70	97.1	2.9	0.0	3.97	4.8	e
6 Spotchem D-Concept	328	97.6	1.2	1.2	4.10	3.8	e
7 Piccolo	20	100.0	0.0	0.0	4.00	1.3	e
8 Cholestech LDX	318	98.1	0.6	1.3	3.99	3.5	e
9 Abx Mira	7	85.7	14.3	0.0	4.20	5.6	e*
10 Hitachi S40/M40	8	100.0	0.0	0.0	4.01	2.6	e
11 Autolyser/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	3.95	3.6	e
12 Autres méthodes	5	80.0	0.0	20.0	3.21	1.6	e

Cholestérol HDL

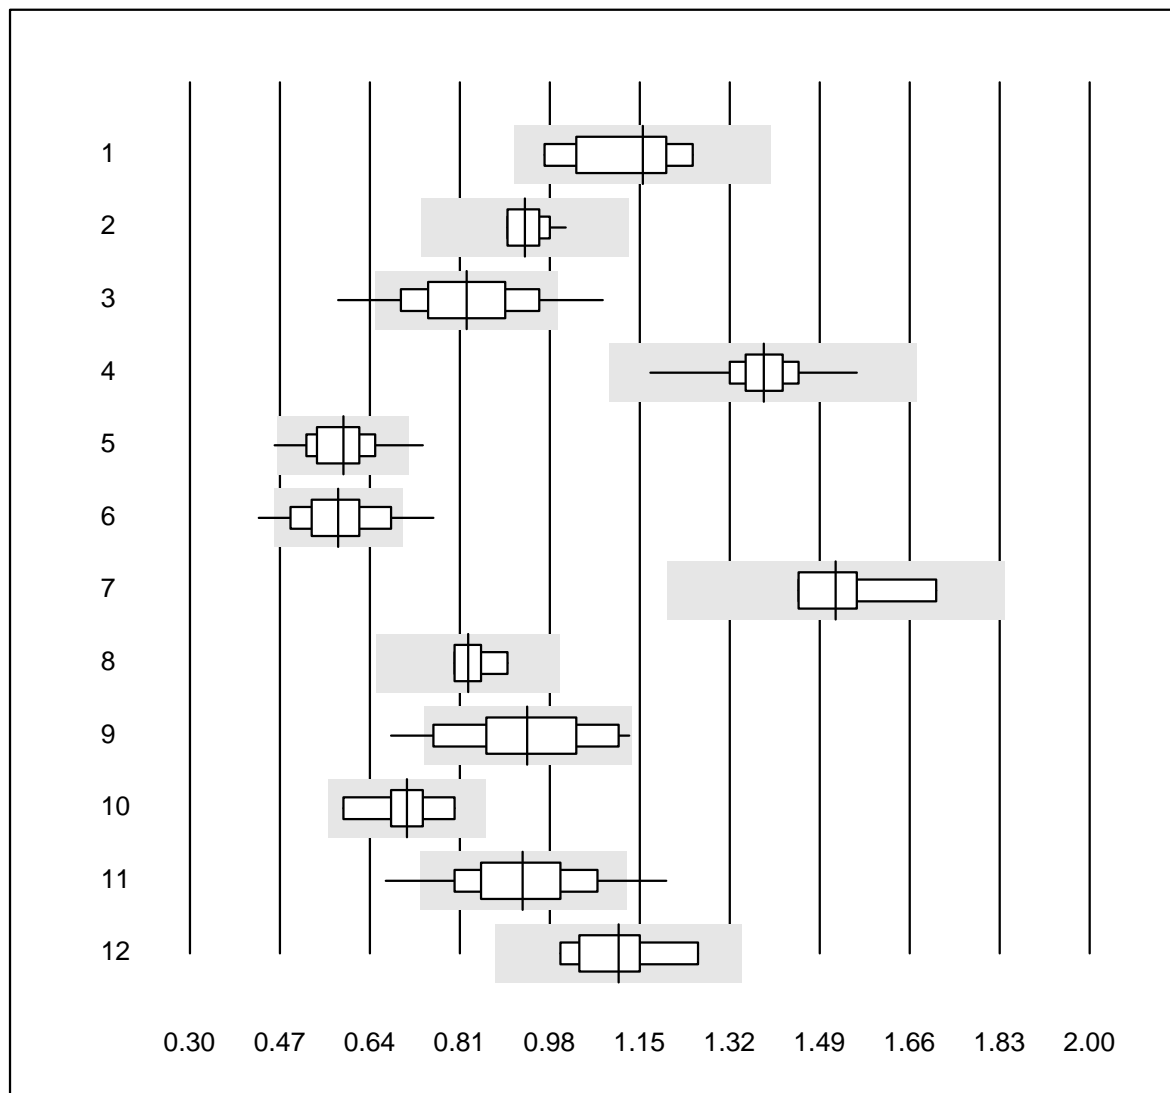


QUALAB Tolérance : 21 %

Cholestérol HDL (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1	humide, direct	8	100.0	0.0	0.0	1.16	8.7	e*
2	Cobas	18	100.0	0.0	0.0	0.93	3.6	e
3	Reflotron	242	86.8	8.7	4.5	0.82	12.5	e
4	Fuji Dri-Chem	795	99.1	0.0	0.9	1.38	3.6	e
5	Spotchem/Ready	63	93.6	3.2	3.2	0.59	9.5	e
6	Spotchem D-Concept	323	91.3	6.5	2.2	0.58	11.7	e
7	Dimension	4	100.0	0.0	0.0	1.52	7.5	e*
8	humide, precipitatio	4	100.0	0.0	0.0	0.83	5.7	e*
9	Piccolo	18	88.8	5.6	5.6	0.94	13.6	e*
10	Pentra/Selectra	9	100.0	0.0	0.0	0.71	8.9	e*
11	Cholestech LDX	319	92.8	5.0	2.2	0.93	11.1	e
12	Hitachi S40/M40	8	87.5	0.0	12.5	1.11	7.9	e*
13	Architect	8	100.0	0.0	0.0	0.86	6.0	e
14	Autolyser/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	1.13	5.5	e

Créatine-kinase

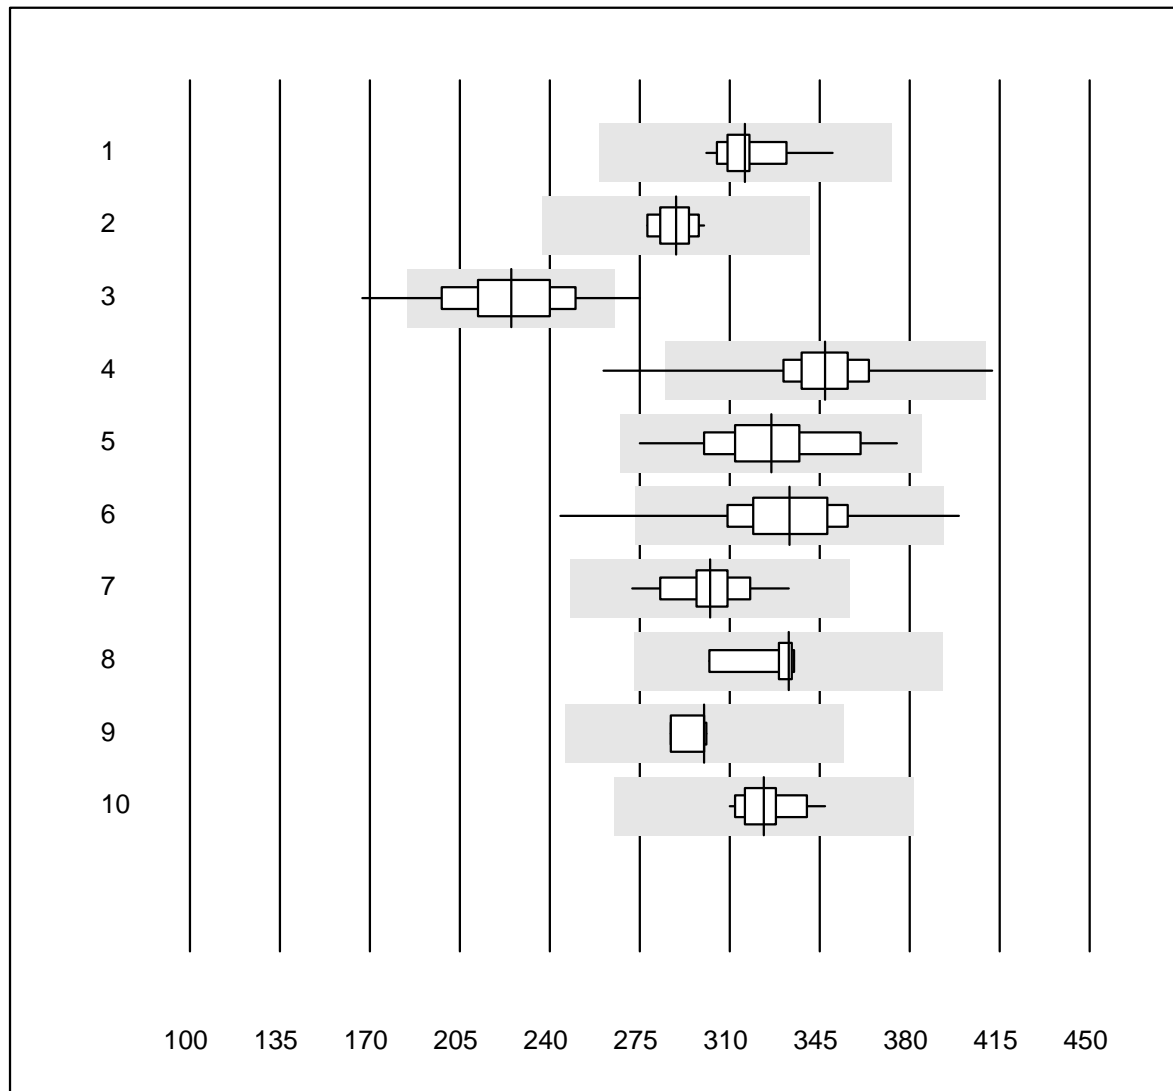


QUALAB Tolérance : 18 %

Créatine-kinase (U/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 IFCC	22	100.0	0.0	0.0	316	3.5	e
2 Cobas	20	100.0	0.0	0.0	289	2.4	e
3 Reflotron	278	90.7	5.0	4.3	225	9.3	e
4 Fuji Dri-Chem	562	98.6	0.7	0.7	347	4.3	e
5 Spotchem/Ready	34	100.0	0.0	0.0	326	6.8	e
6 Spotchem D-Concept	205	96.6	1.0	2.4	333	6.3	e
7 Piccolo	21	100.0	0.0	0.0	302	4.8	e
8 Abx Mira	5	100.0	0.0	0.0	333	4.3	e
9 Dimension	4	100.0	0.0	0.0	300	2.3	e
10 Autolyser/DiaSys	15	100.0	0.0	0.0	323	3.1	e

Cholestérol LDL

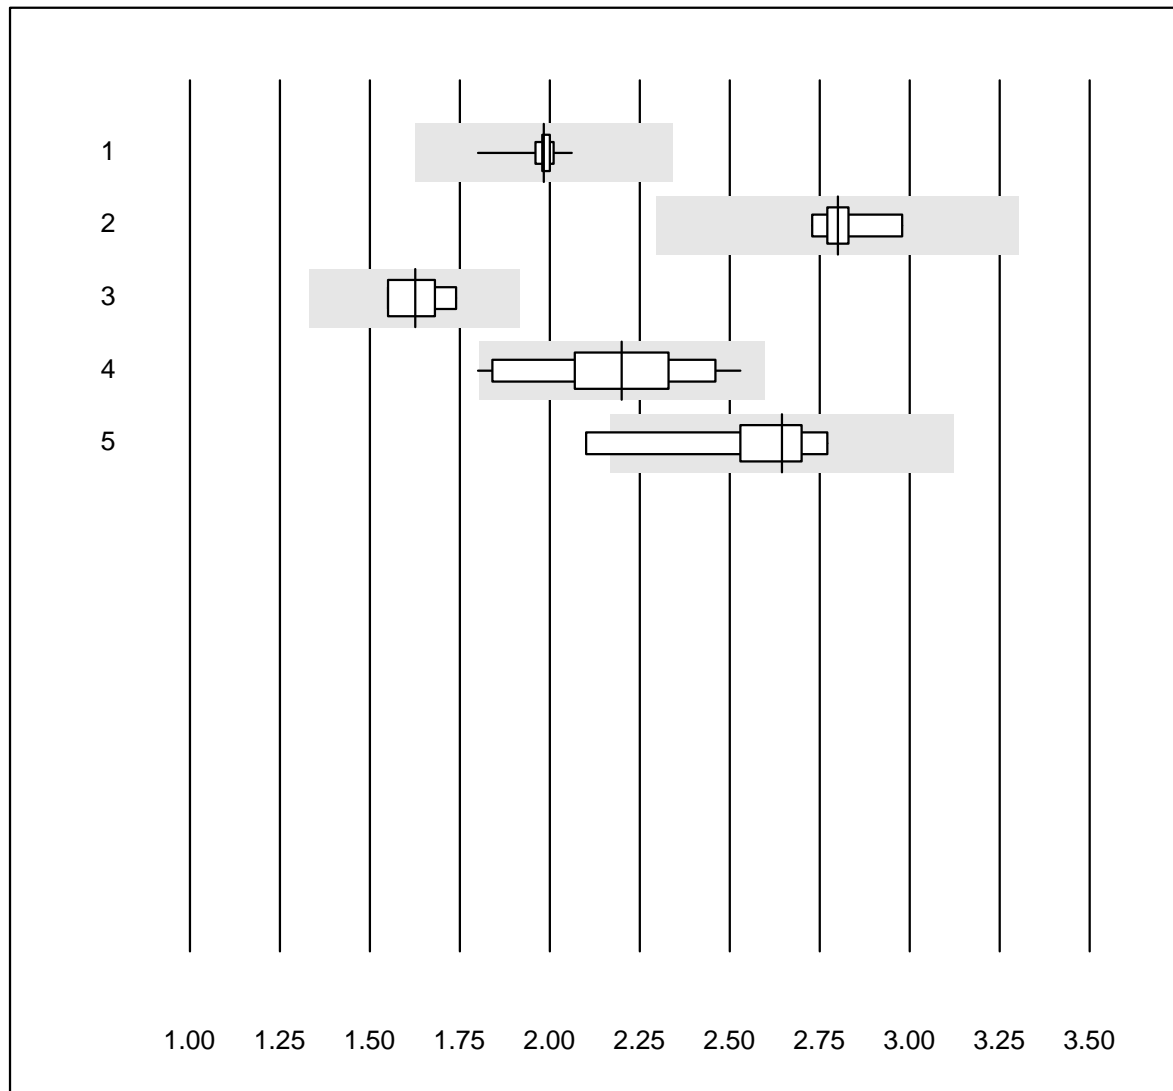


QUALAB Tolérance : 18 %

Cholestérol LDL (mmol/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Chimie humide	11	100.0	0.0	0.0	2.0	3.3	e
2 Roche, Cobas	9	100.0	0.0	0.0	2.8	2.7	e
3 Hitachi S40/M40	4	100.0	0.0	0.0	1.6	5.5	e*
4 Autolyser/DiaSys	13	92.3	7.7	0.0	2.2	10.7	e*
5 Beckman	6	83.3	16.7	0.0	2.6	9.5	e*

Fer

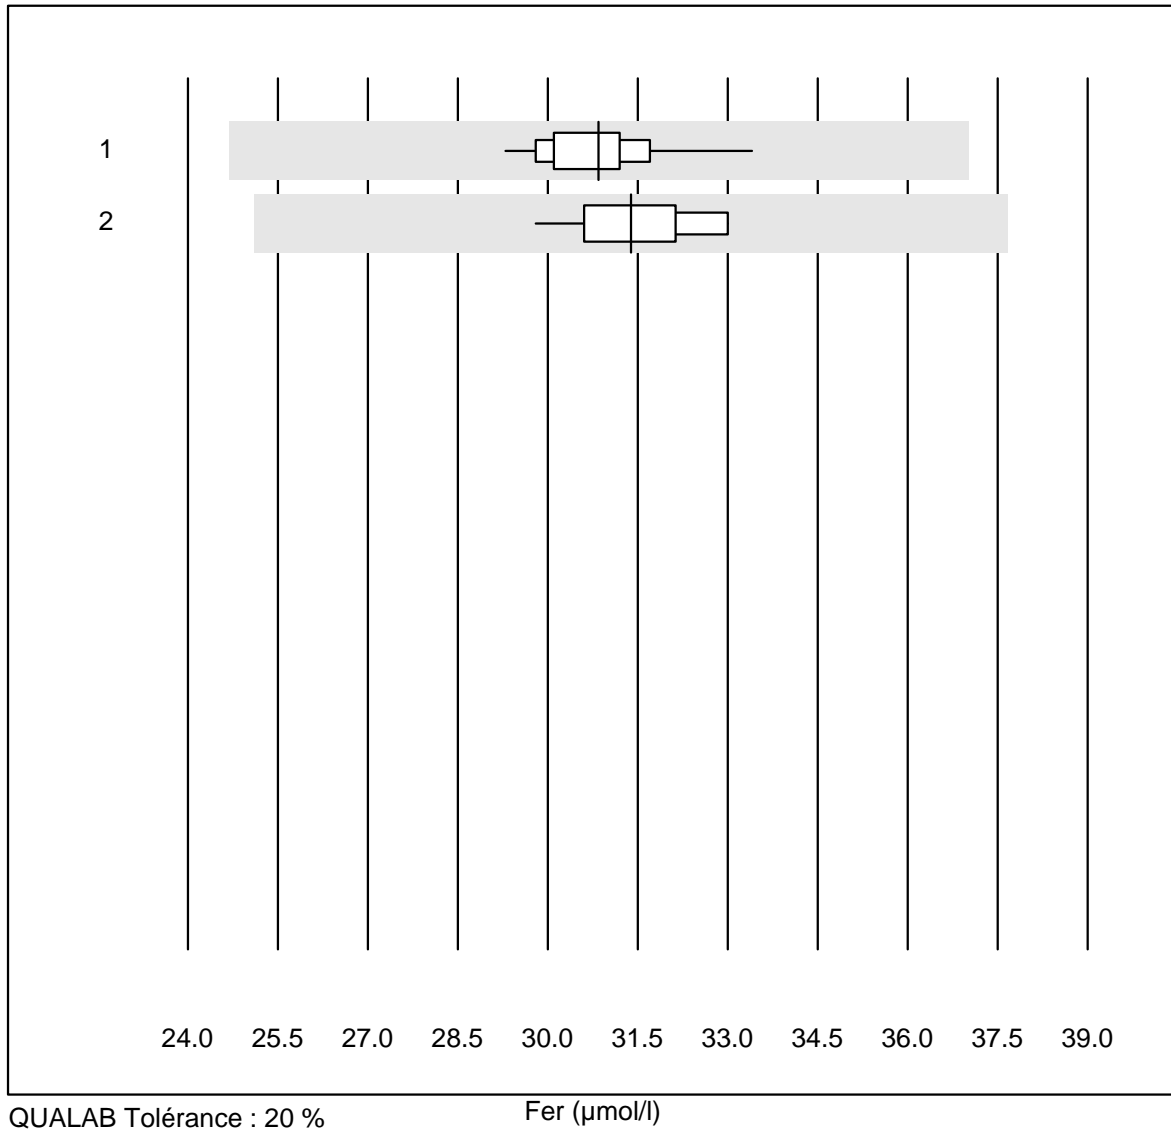

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Chimie humide	16	100.0	0.0	0.0	31	3.0	e
2 Cobas	12	100.0	0.0	0.0	31	3.3	e

Gamma-GT

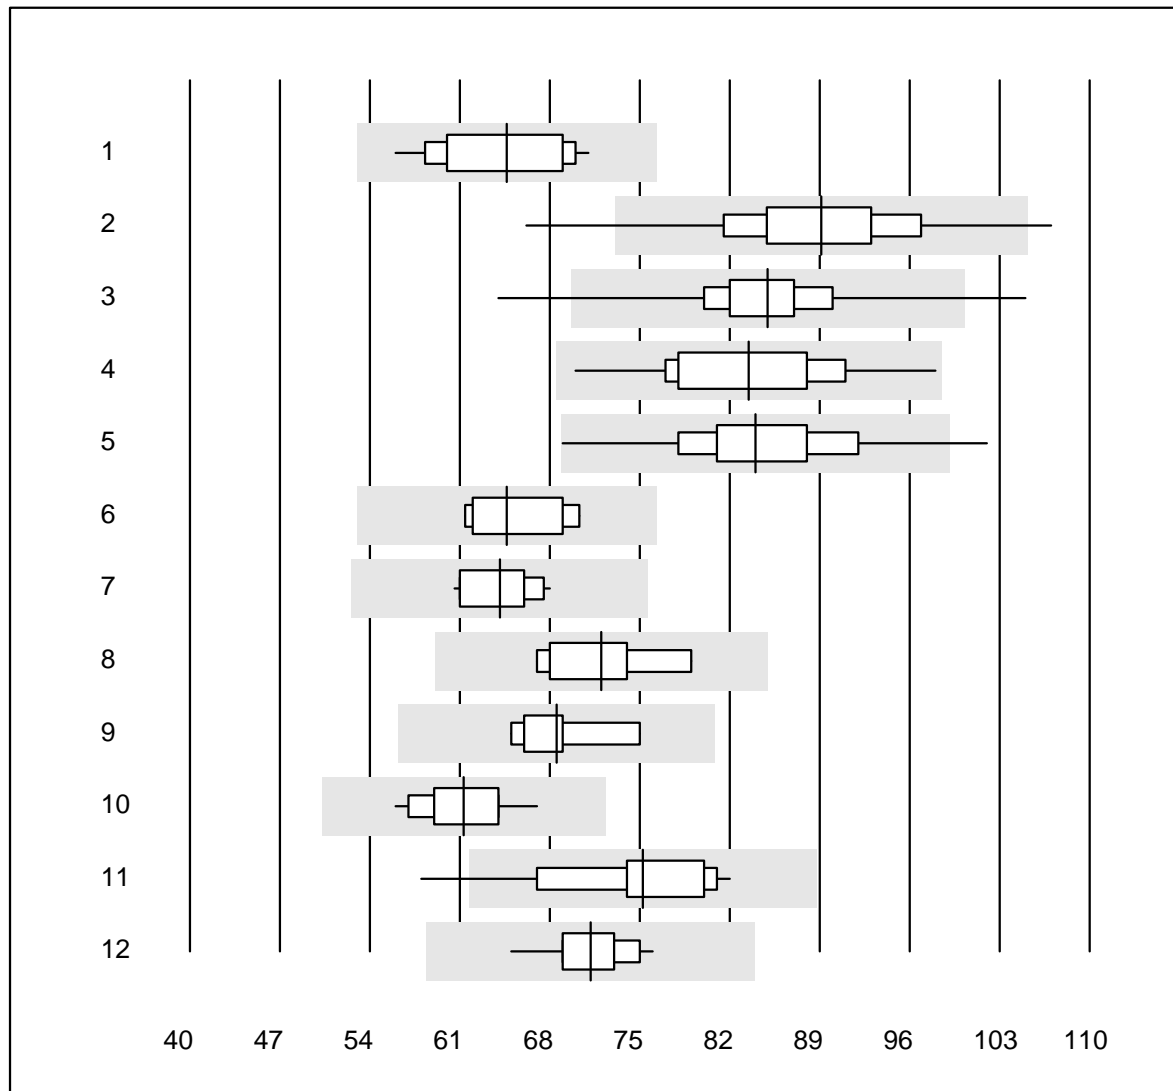


QUALAB Tolérance : 18 %

Gamma-GT (U/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas	22	100.0	0.0	0.0	65	7.7	e
2 Reflotron	567	97.6	1.2	1.2	89	6.8	e
3 Fuji Dri-Chem	915	99.6	0.2	0.2	85	5.1	e
4 Spotchem/Ready	78	100.0	0.0	0.0	83	6.7	e
5 Spotchem D-Concept	374	98.9	0.3	0.8	84	6.2	e
6 Selectra/Biolis	6	100.0	0.0	0.0	65	5.7	e*
7 Architect	11	100.0	0.0	0.0	64	4.3	e
8 Dimension	5	100.0	0.0	0.0	72	6.7	e*
9 IFCC Beckmann	8	100.0	0.0	0.0	69	4.5	e
10 Piccolo	45	100.0	0.0	0.0	61	4.6	e
11 Hitachi S40/M40	13	92.3	7.7	0.0	75	8.6	e*
12 Autolyser/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	71	3.7	e

Glucose

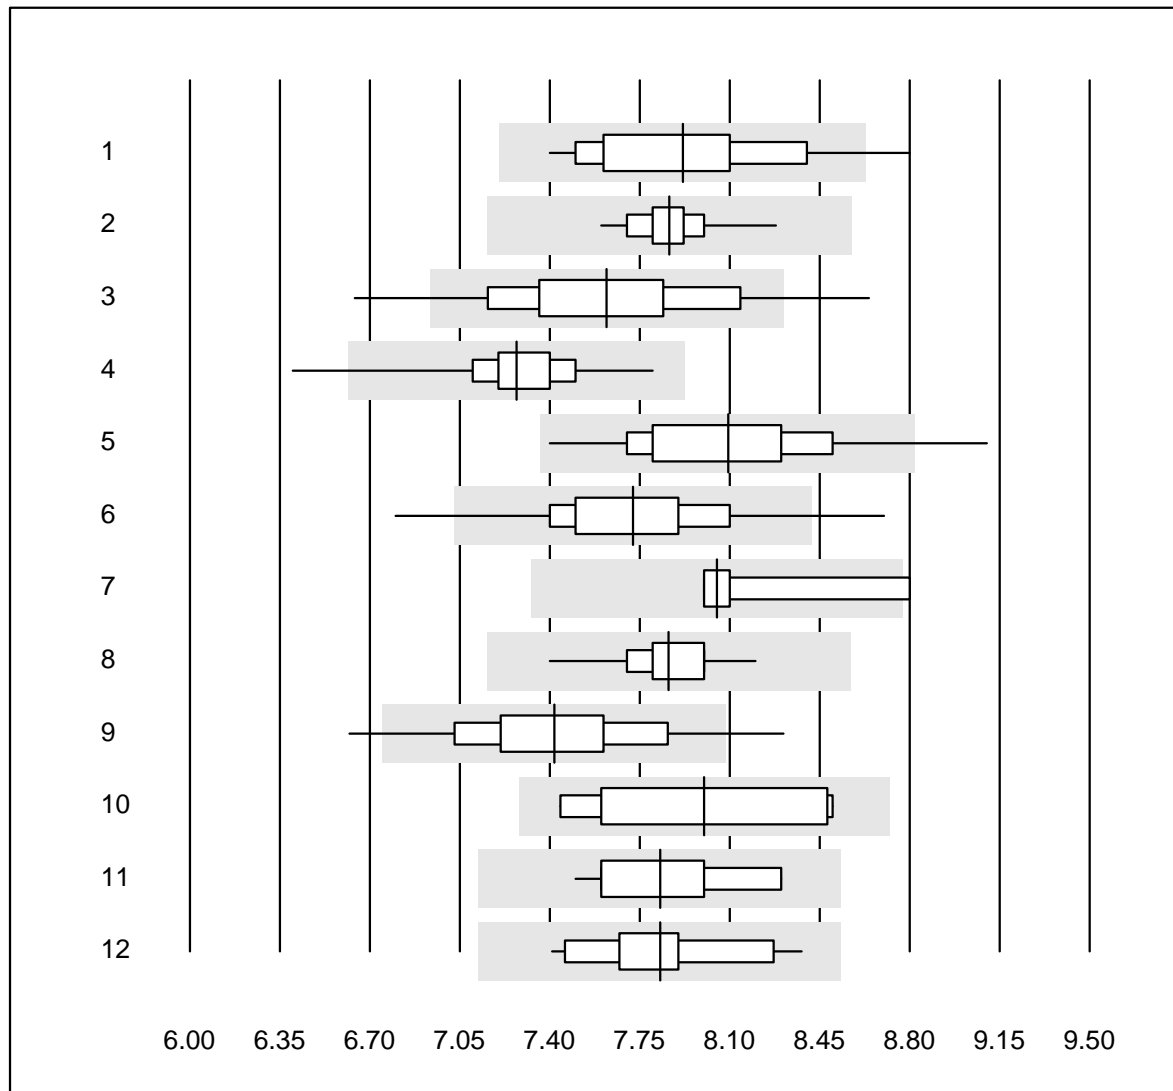


QUALAB Tolérance : 9 %

Glucose (mmol/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Chimie humide	29	96.6	3.4	0.0	7.9	4.4	e
2 Cobas	21	100.0	0.0	0.0	7.9	1.8	e
3 Reflotron	555	91.0	4.9	4.1	7.6	4.8	e
4 Fuji Dri-Chem	863	98.9	0.8	0.3	7.3	2.5	e
5 Spotchem/Ready	71	98.6	1.4	0.0	8.1	4.2	e
6 Spotchem D-Concept	347	95.3	3.5	1.2	7.7	3.7	e
7 Dimension	4	75.0	25.0	0.0	8.1	4.7	e*
8 Piccolo	59	100.0	0.0	0.0	7.9	1.9	e
9 Cholestech LDX	311	95.8	1.9	2.3	7.4	4.1	e
10 Abx Mira	7	100.0	0.0	0.0	8.0	5.2	e*
11 Hitachi S40/M40	15	93.3	0.0	6.7	7.8	3.3	e
12 Autolyser/DiaSys	18	94.4	0.0	5.6	7.8	3.4	e
13 iStat Chem8	7	100.0	0.0	0.0	7.1	2.0	e

Glucose

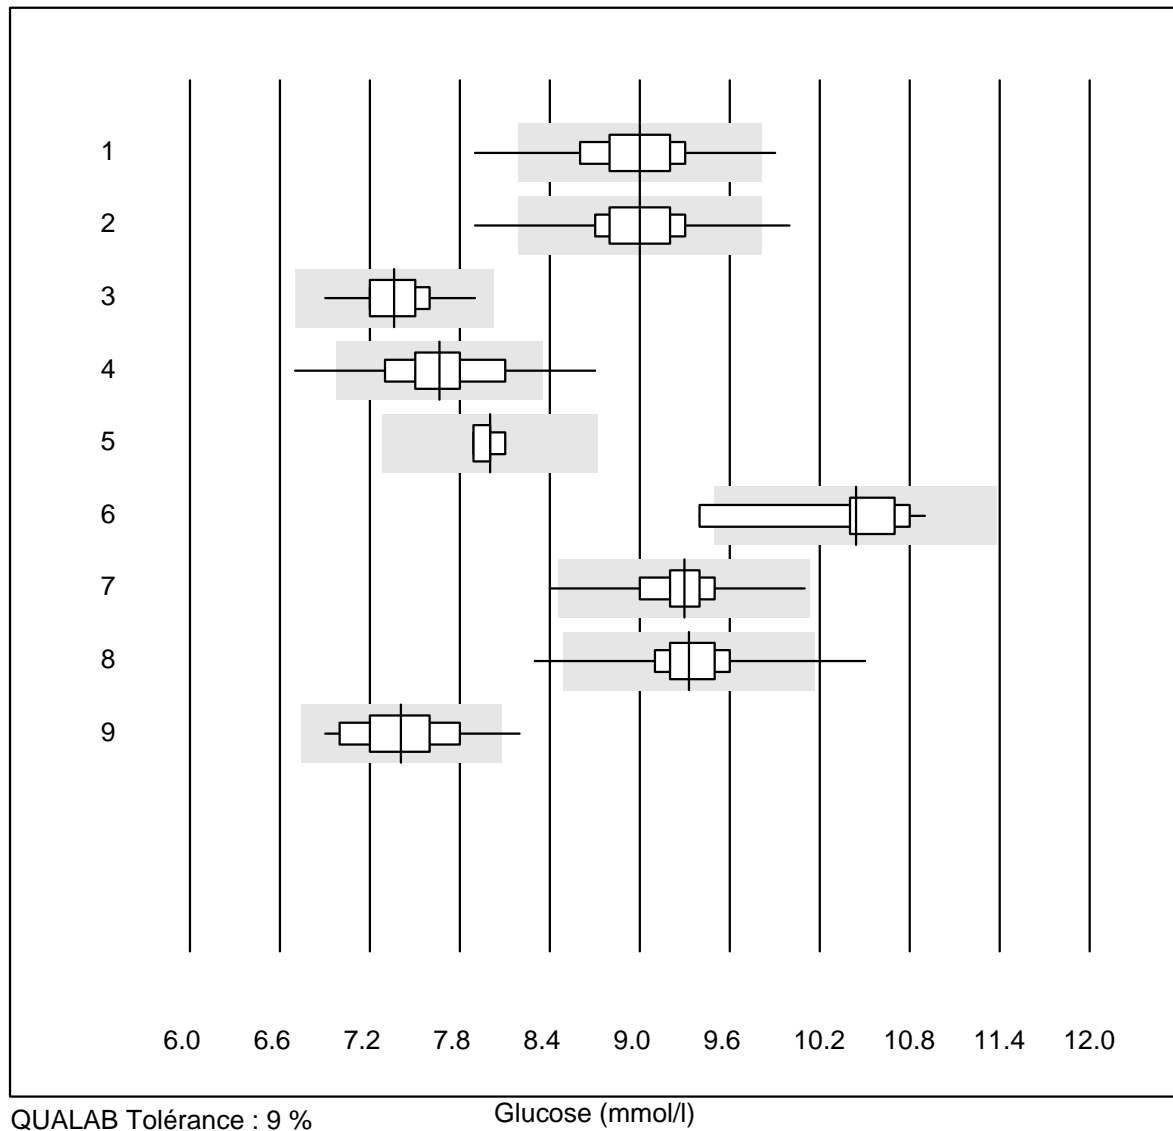


No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1	Accu-Chek Aviva	326	96.0	1.5	2.5	9.0	3.4	e
2	Accu-Chek Inform 2	722	98.9	1.0	0.1	9.0	3.0	e
3	Accu-Check Guide	244	98.8	0.0	1.2	7.4	2.5	e
4	Contour XT	1307	95.0	2.7	2.3	7.7	3.8	e
5	Skylla	4	100.0	0.0	0.0	8.0	1.1	e
6	Glucocard	12	75.0	8.3	16.7	10.4	4.4	e*
7	Hemocue 201+ P-equiv	97	95.9	1.0	3.1	9.3	2.8	e
8	Hemocue 201RT P-equi	120	95.0	3.3	1.7	9.3	3.1	e
9	Contour NEXT	12	91.7	8.3	0.0	7.4	5.1	e*

Glucose

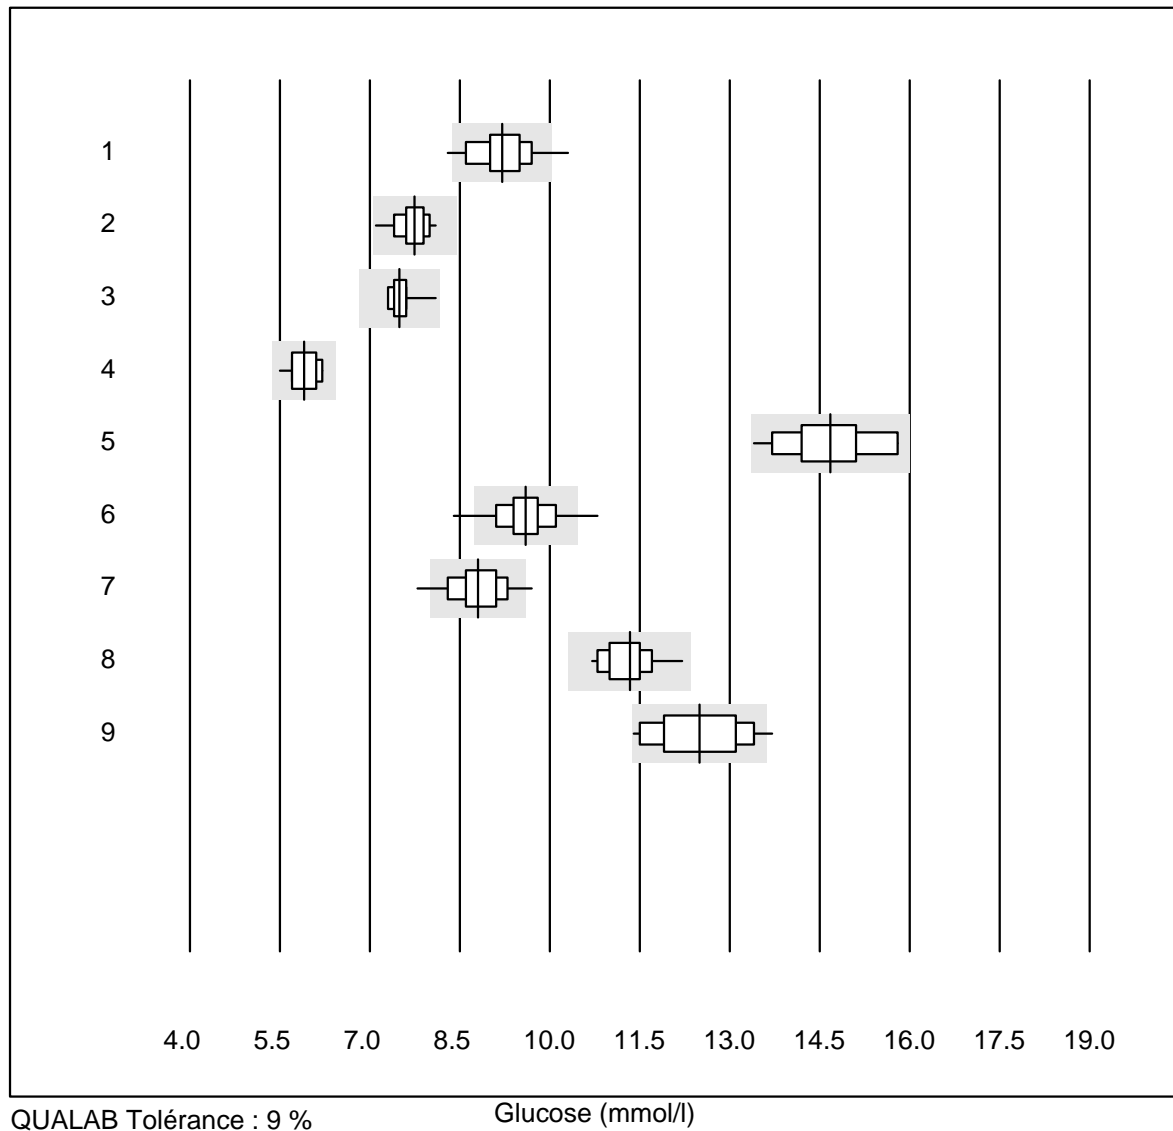

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Hemocue 201+ (alt)	42	92.9	7.1	0.0	9.2	4.6	e
2 AccuChek Sensor	31	93.5	0.0	6.5	7.7	2.8	e
3 OneTouch Verio	25	100.0	0.0	0.0	7.5	2.2	e
4 Contour 2 (5s)	15	100.0	0.0	0.0	5.9	3.7	e
5 Healthpro	28	100.0	0.0	0.0	14.7	4.7	e
6 Mylife UNIO	321	94.7	1.6	3.7	9.6	3.7	e
7 mylife Pura	74	93.2	5.4	1.4	8.8	4.6	e
8 Omnitest	15	93.3	0.0	6.7	11.3	3.4	e
9 Alpha Check	23	69.6	4.3	26.1	12.5	5.7	e*

Acide urique

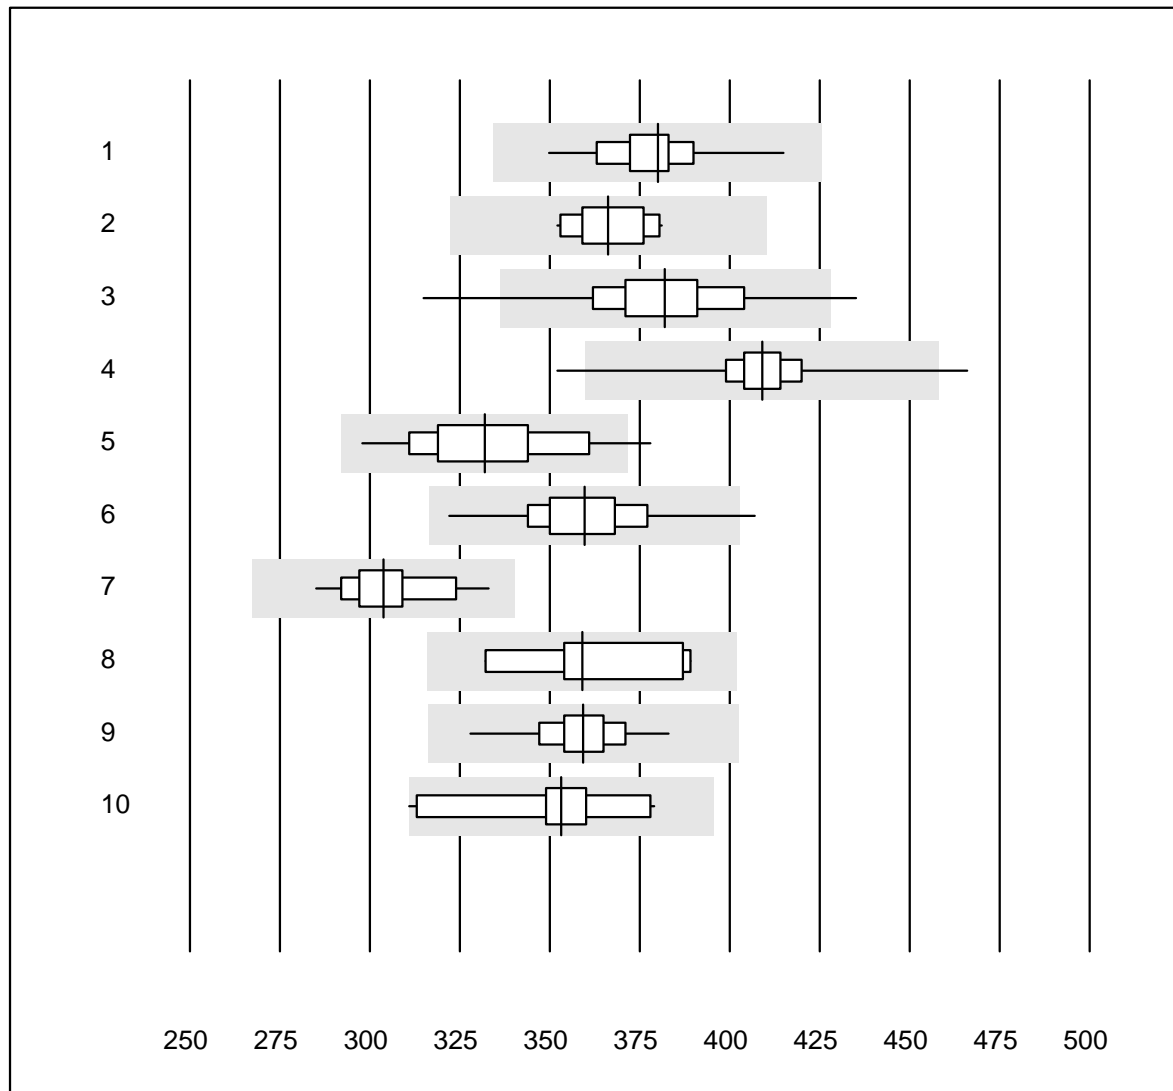


QUALAB Tolérance : 12 %

Acide urique (µmol/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Chimie humide	31	93.5	0.0	6.5	380	3.4	e
2 Cobas	19	100.0	0.0	0.0	366	2.7	e
3 Reflotron	490	97.6	1.0	1.4	382	4.4	e
4 Fuji Dri-Chem	852	99.4	0.2	0.4	409	2.2	e
5 Spotchem/Ready	62	98.4	1.6	0.0	332	5.8	e
6 Spotchem D-Concept	343	98.5	0.3	1.2	360	3.6	e
7 Piccolo	27	100.0	0.0	0.0	304	3.8	e
8 Abx Mira	7	100.0	0.0	0.0	359	5.5	e*
9 Hitachi S40/M40	14	100.0	0.0	0.0	359	3.6	e
10 Autolyser/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	353	5.2	e

Urée

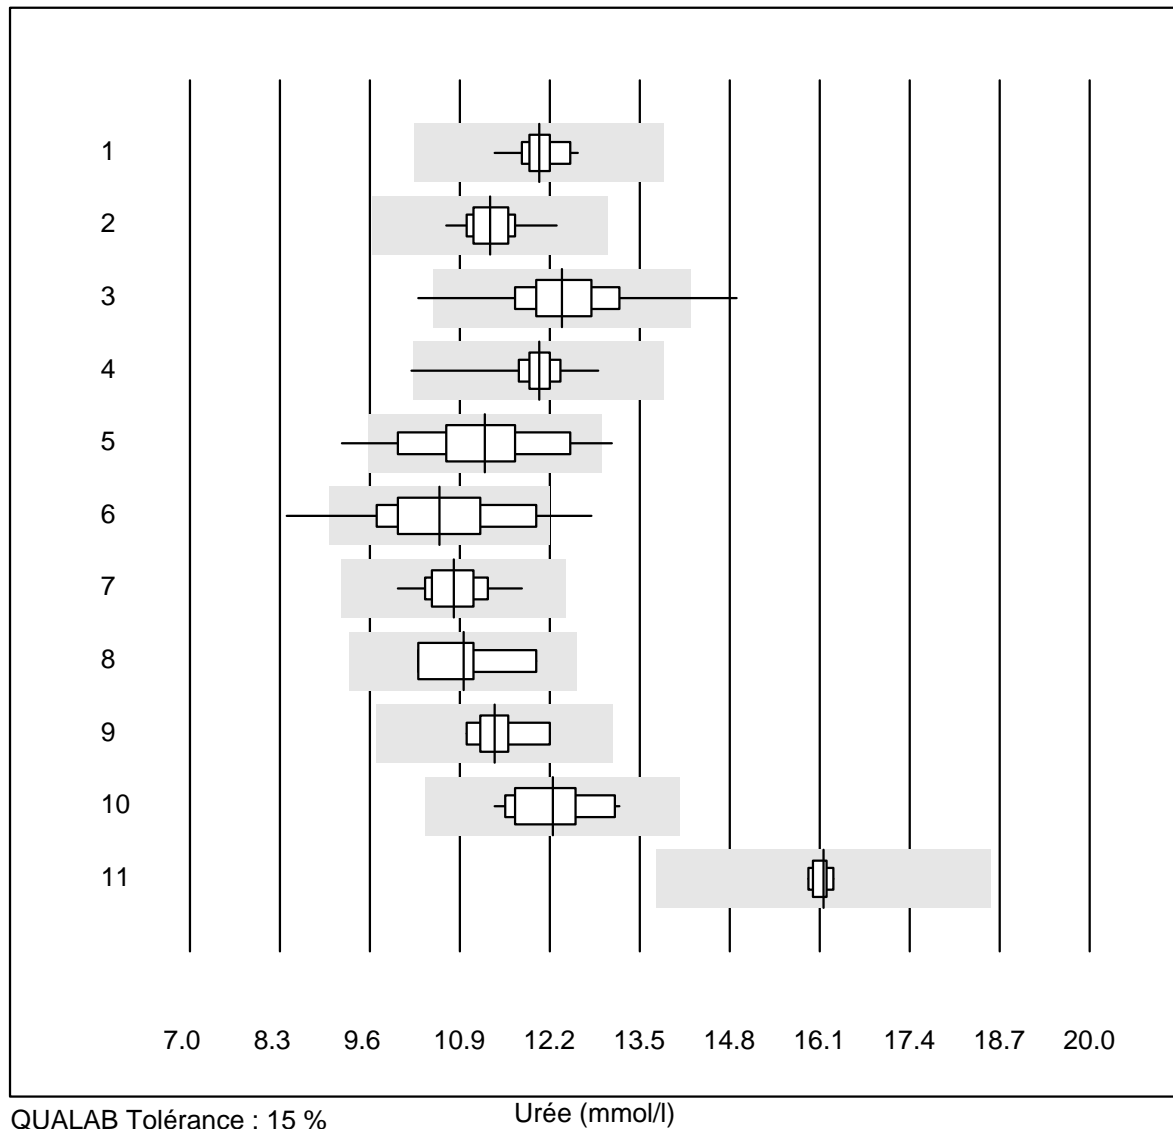


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Chimie humide	27	100.0	0.0	0.0	12.0	2.4	e
2 Cobas	20	100.0	0.0	0.0	11.3	3.2	e
3 Reflotron	226	97.8	0.9	1.3	12.4	5.1	e
4 Fuji Dri-Chem	513	99.4	0.4	0.2	12.0	2.3	e
5 Spotchem/Ready	42	90.5	9.5	0.0	11.3	8.2	e
6 Spotchem D-Concept	212	85.9	7.5	6.6	10.6	8.1	e
7 Piccolo	52	98.1	0.0	1.9	10.8	3.7	e
8 Skyla	4	100.0	0.0	0.0	11.0	6.5	e*
9 Hitachi S40/M40	9	88.9	0.0	11.1	11.4	3.3	e
10 Autolyser/DiaSys	14	100.0	0.0	0.0	12.2	4.7	e
11 iStat Chem8	6	100.0	0.0	0.0	16.2	0.8	e

Potassium

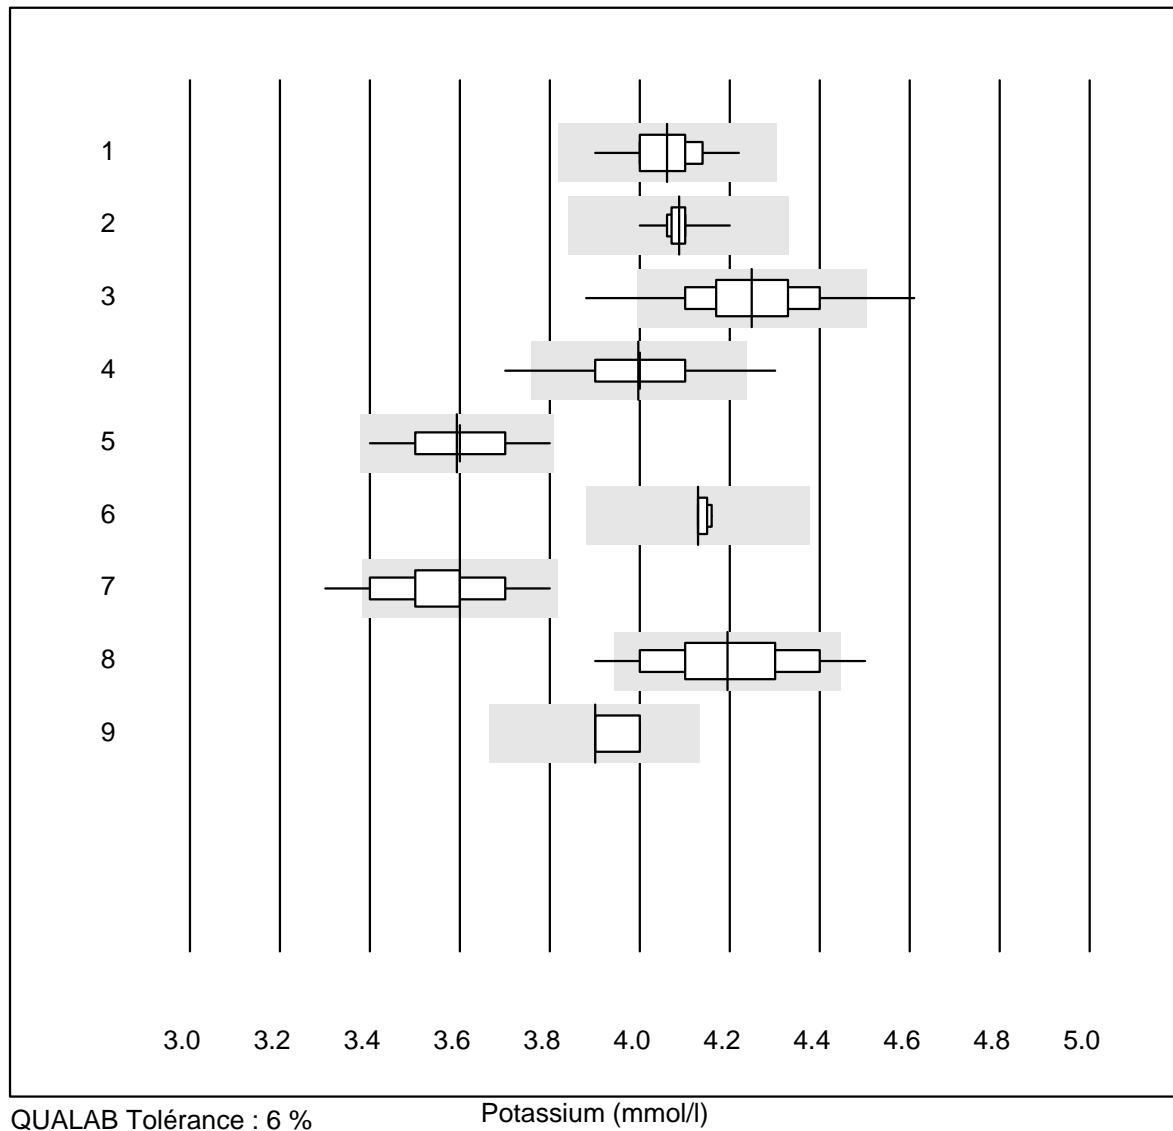


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 ISE	40	100.0	0.0	0.0	4.06	1.8	e
2 Cobas	21	100.0	0.0	0.0	4.09	1.0	e
3 Reflotron	505	92.6	4.6	2.8	4.25	2.9	e
4 Fuji Dri-Chem	900	98.9	0.8	0.3	4.00	1.7	e
5 Spotchem D-Concept	351	98.6	0.0	1.4	3.59	1.8	e
6 Autolyser/DiaSys	5	80.0	0.0	20.0	4.13	0.4	e
7 Spotchem EL-SE 1520	66	98.5	1.5	0.0	3.60	2.5	e
8 Piccolo	39	87.2	5.1	7.7	4.19	3.5	e
9 iStat Chem8	8	100.0	0.0	0.0	3.90	1.3	e

Créatinine

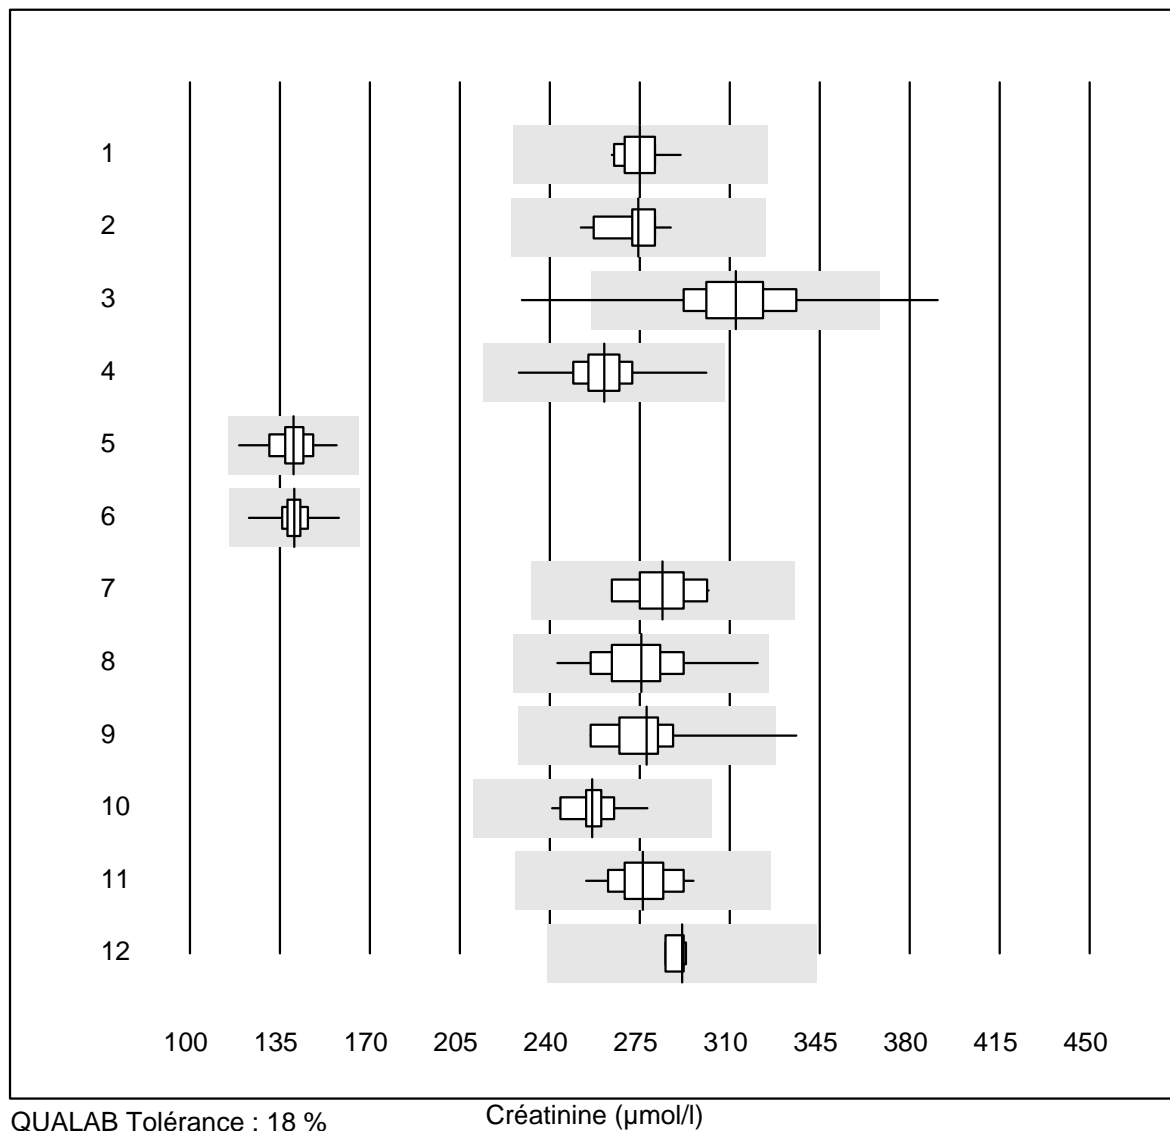

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Chimie humide	13	100.0	0.0	0.0	275	2.8	e
2 Cobas	20	100.0	0.0	0.0	274	3.1	e
3 Reflotron	671	96.2	1.9	1.9	312	6.2	e
4 Fuji Dri-Chem	939	99.5	0.0	0.5	261	3.5	e
5 Spotchem/Ready	85	98.8	0.0	1.2	140	4.6	e
6 Spotchem D-Concept	372	99.7	0.0	0.3	141	3.2	e
7 Enzymatisch	10	100.0	0.0	0.0	284	4.3	e
8 Piccolo	60	98.3	0.0	1.7	276	5.1	e
9 Abx Mira	10	90.0	10.0	0.0	278	8.1	e*
10 Hitachi S40/M40	15	93.3	0.0	6.7	257	3.6	e
11 Autolyser/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	276	3.8	e
12 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	292	1.2	e
13 EPOC	9	100.0	0.0	0.0	271	6.7	e*

Créatinine E

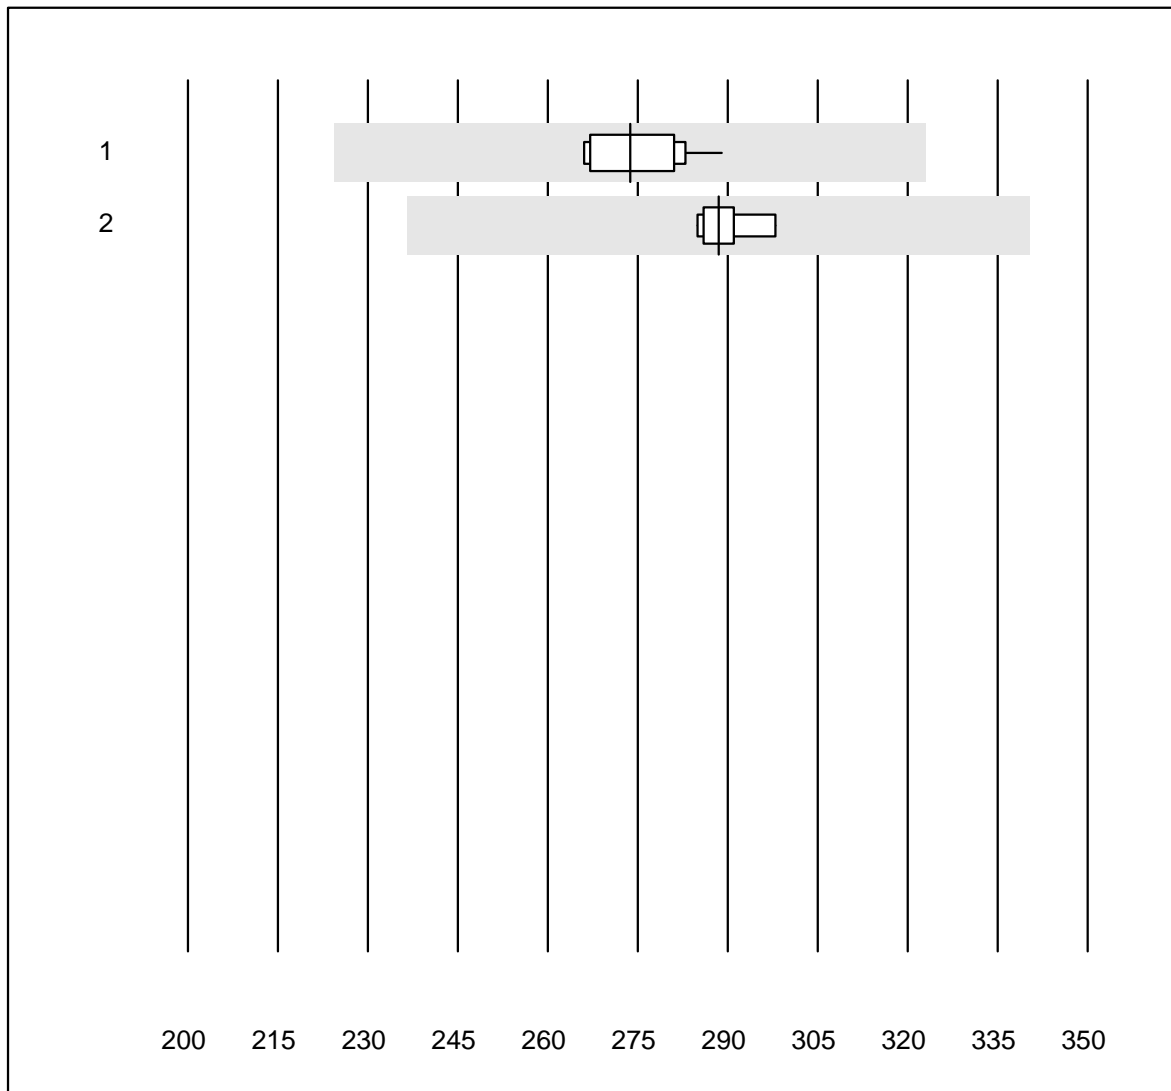


QUALAB Tolérance : 18 %

Créatinine E (µmol/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 iStat Chem8	11	100.0	0.0	0.0	274	2.7	e
2 ABL700/800	8	100.0	0.0	0.0	289	1.4	e

eGFR CKD-EPI

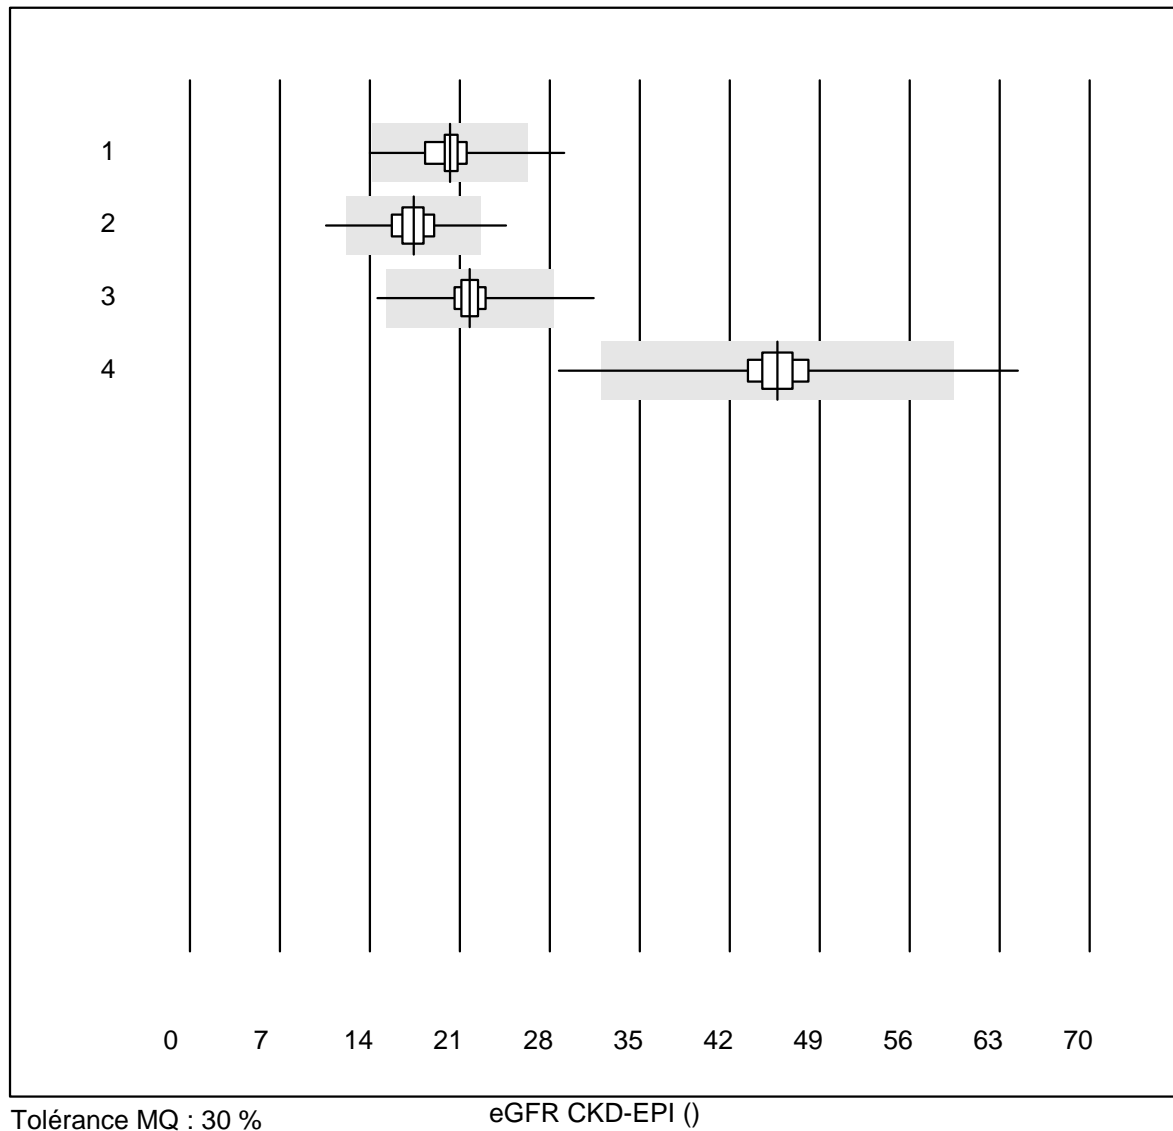


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Chimie humide	65	90.7	6.2	3.1	20	11.3	e
2 Reflotron	199	95.0	1.5	3.5	17	9.5	e
3 Fuji Dri-Chem	366	96.5	1.6	1.9	22	6.6	e
4 Spotchem/Ready	172	96.0	1.7	2.3	46	8.1	e

eGFR Cockcroft-Gault

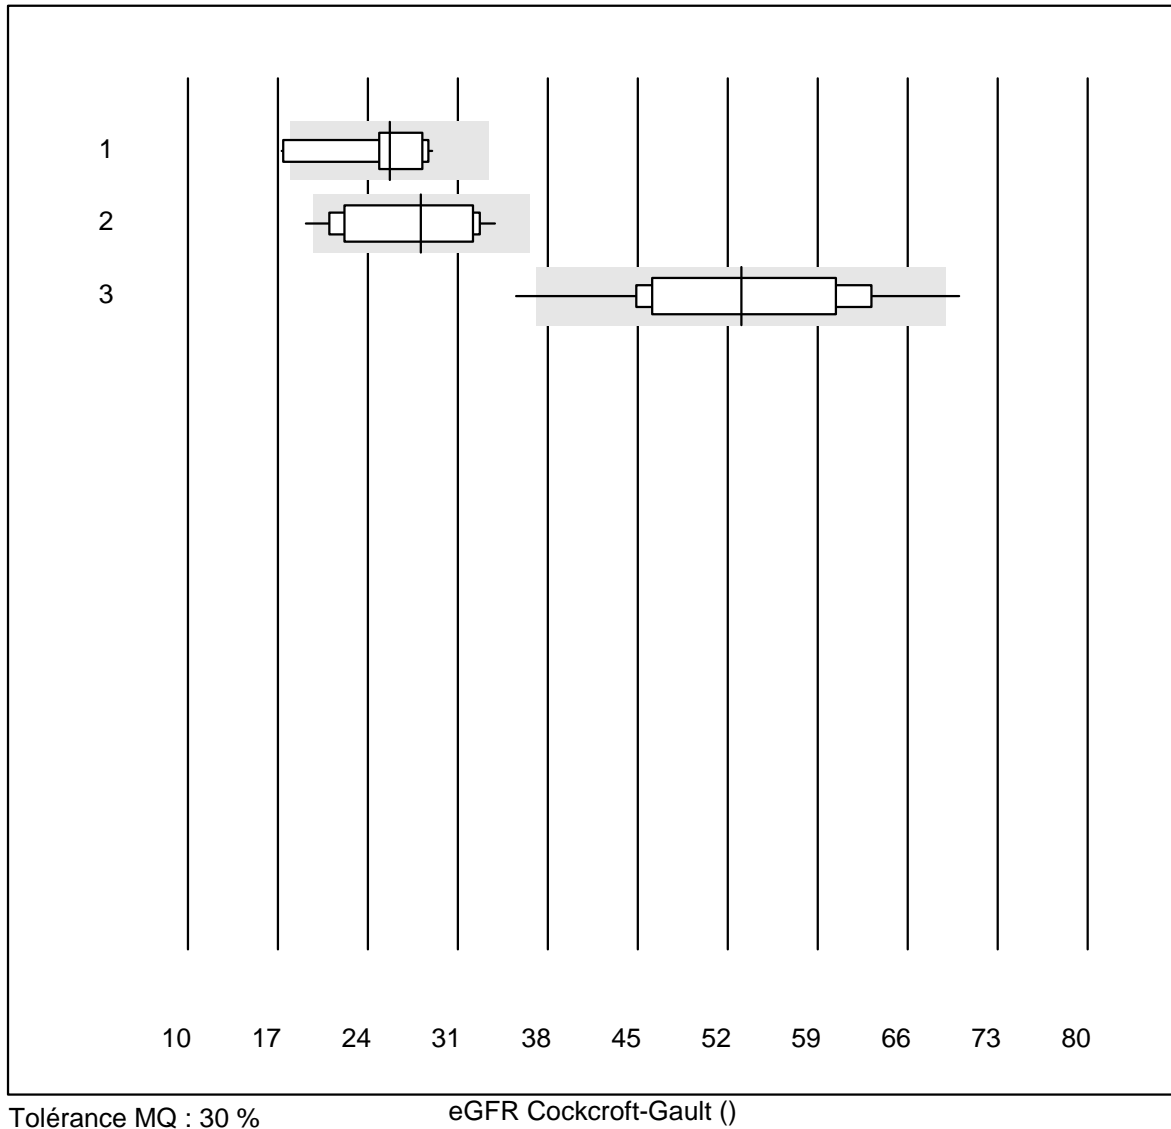

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Reflotron	20	85.0	10.0	5.0	26	13.2	e
2 Fuji Dri-Chem	42	95.2	2.4	2.4	28	17.7	e
3 Spotchem/Ready	19	89.5	10.5	0.0	53	16.6	e*

eGFR MDRD

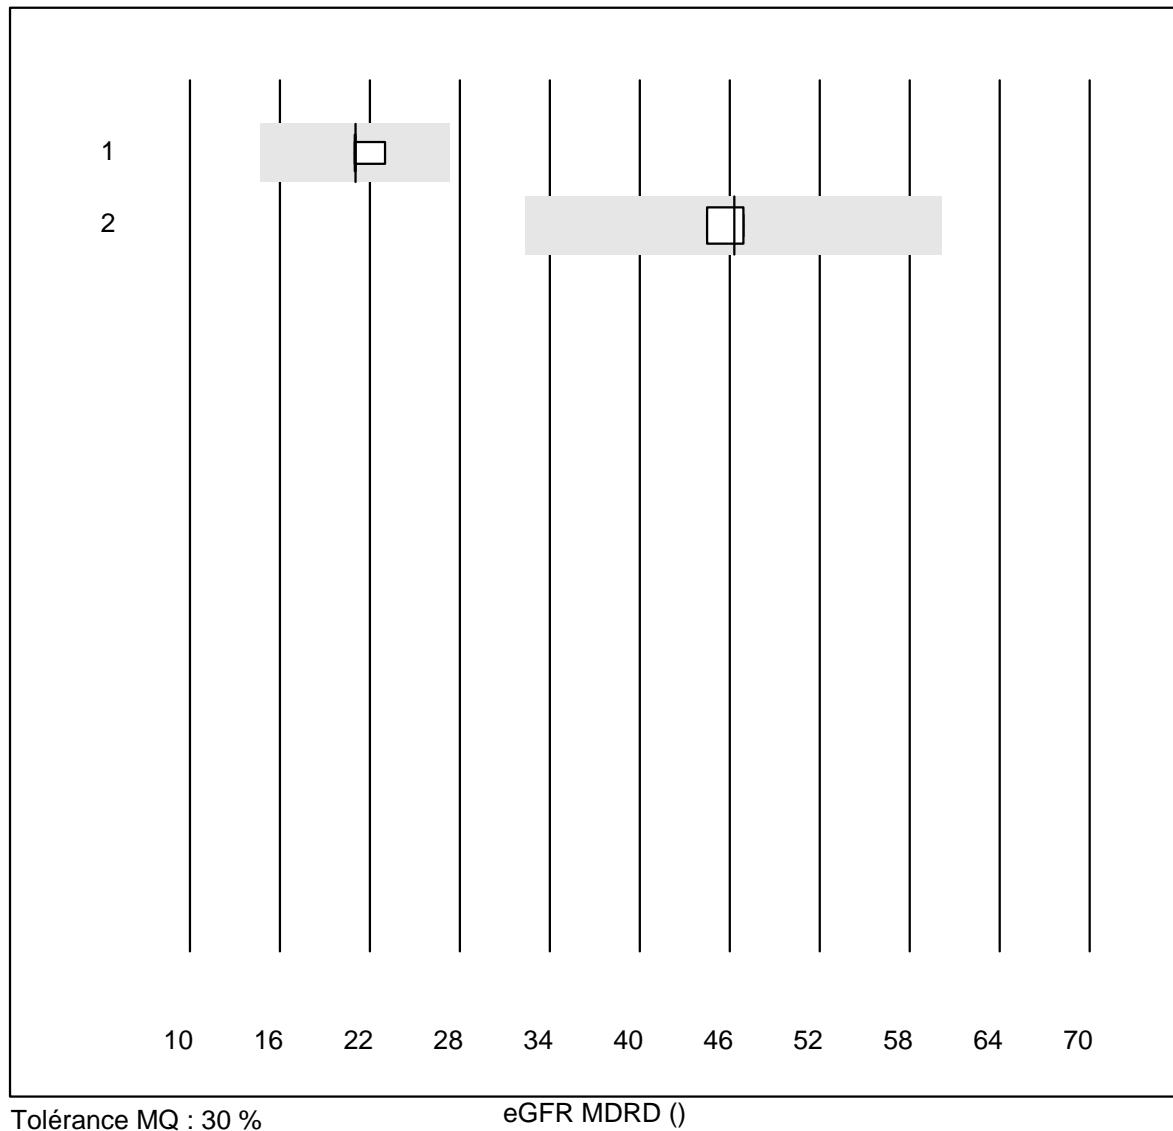


Tolérance MQ : 30 %

eGFR MDRD ()


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Fuji Dri-Chem	4	100.0	0.0	0.0	21	4.6	e
2 Spotchem/Ready	4	75.0	0.0	25.0	46	2.6	e

LDH

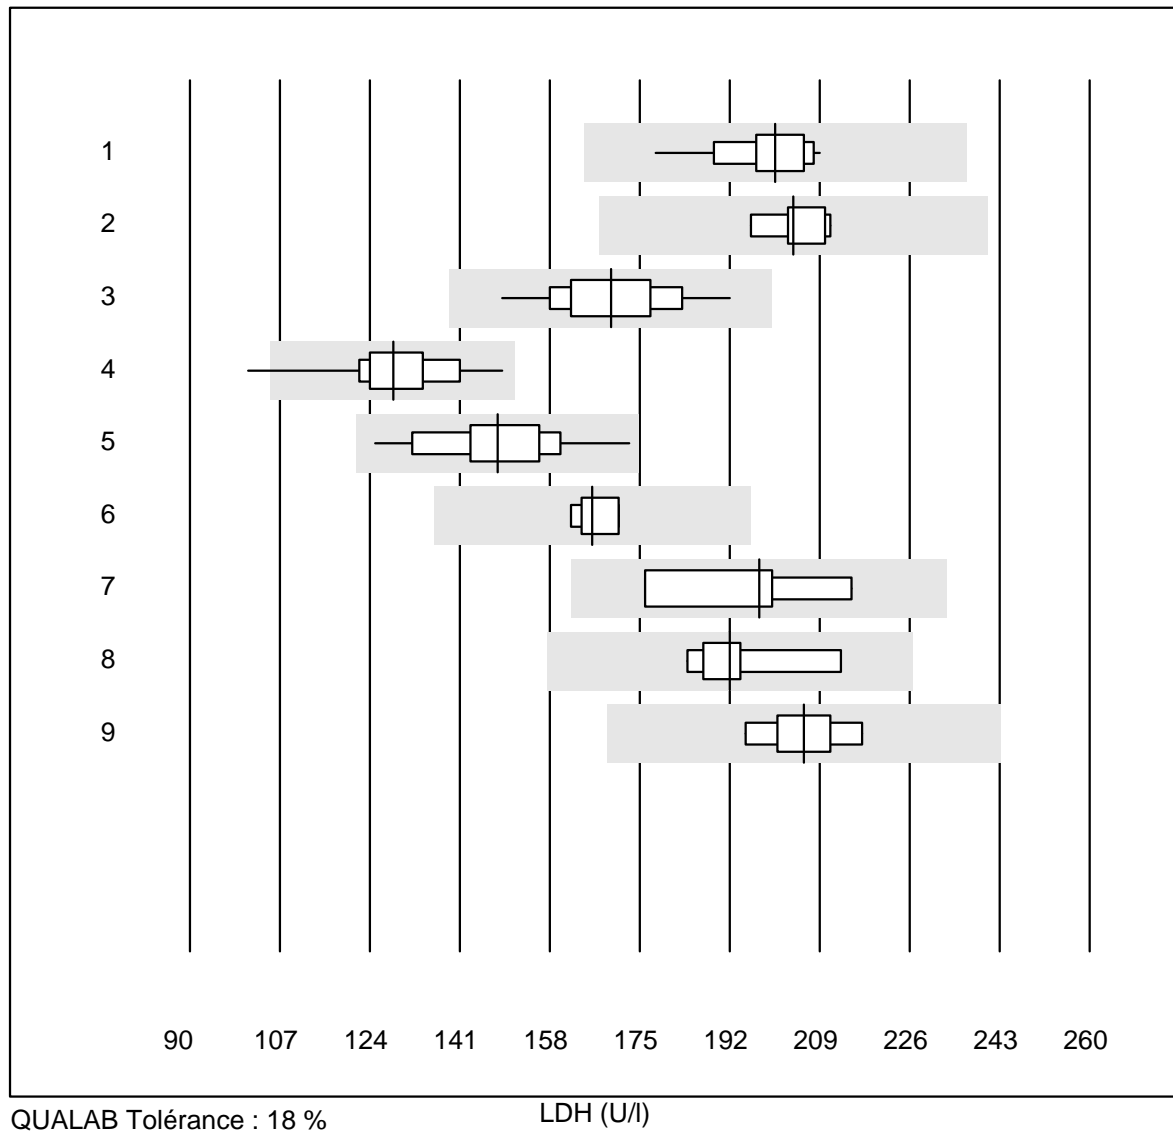

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 IFCC	38	100.0	0.0	0.0	201	3.6	e
2 Cobas	6	100.0	0.0	0.0	204	2.7	e
3 Fuji Dri-Chem	141	98.6	0.0	1.4	170	5.5	e
4 Spotchem/Ready	13	92.3	7.7	0.0	128	9.0	e*
5 Spotchem D-Concept	41	90.2	0.0	9.8	148	7.7	e
6 Piccolo	5	100.0	0.0	0.0	166	2.5	e
7 Abx Mira	4	100.0	0.0	0.0	198	8.2	e*
8 Hitachi S40/M40	6	100.0	0.0	0.0	192	5.3	e
9 Autolysér/DiaSys	9	100.0	0.0	0.0	206	3.8	e

Magnésium

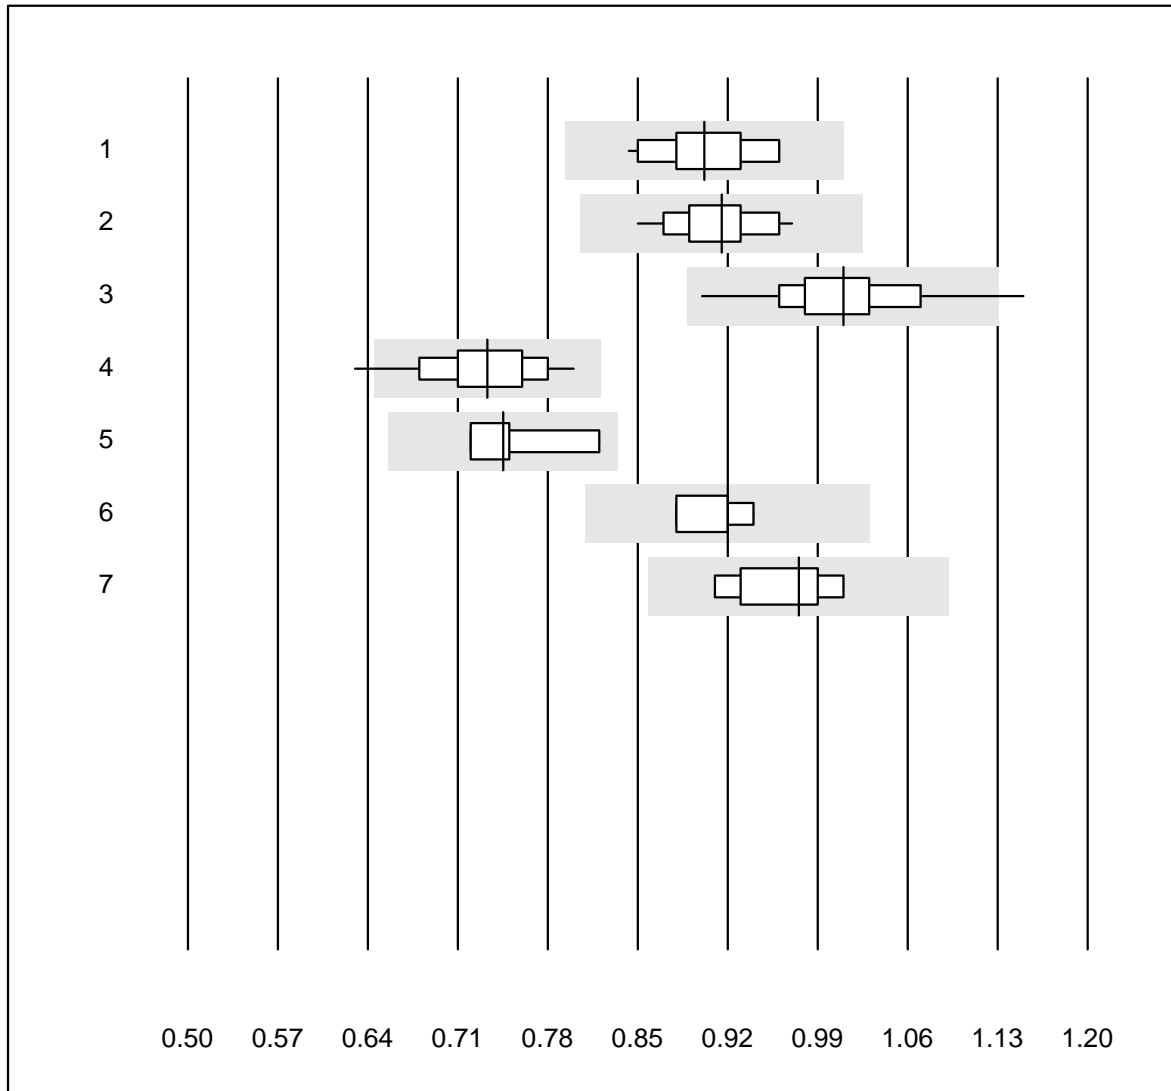


QUALAB Tolérance : 12 %

Magnésium (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Chimie humide	19	100.0	0.0	0.0	0.90	3.8	e
2 Cobas	15	100.0	0.0	0.0	0.92	3.6	e
3 Fuji Dri-Chem	108	97.2	0.9	1.9	1.01	4.3	e
4 Spotchem D-Concept	41	95.2	2.4	2.4	0.73	5.2	e
5 Spotchem/Ready	4	100.0	0.0	0.0	0.75	5.7	e*
6 Beckman	6	100.0	0.0	0.0	0.92	2.7	e
7 Piccolo	6	100.0	0.0	0.0	0.98	3.9	e*

Sodium

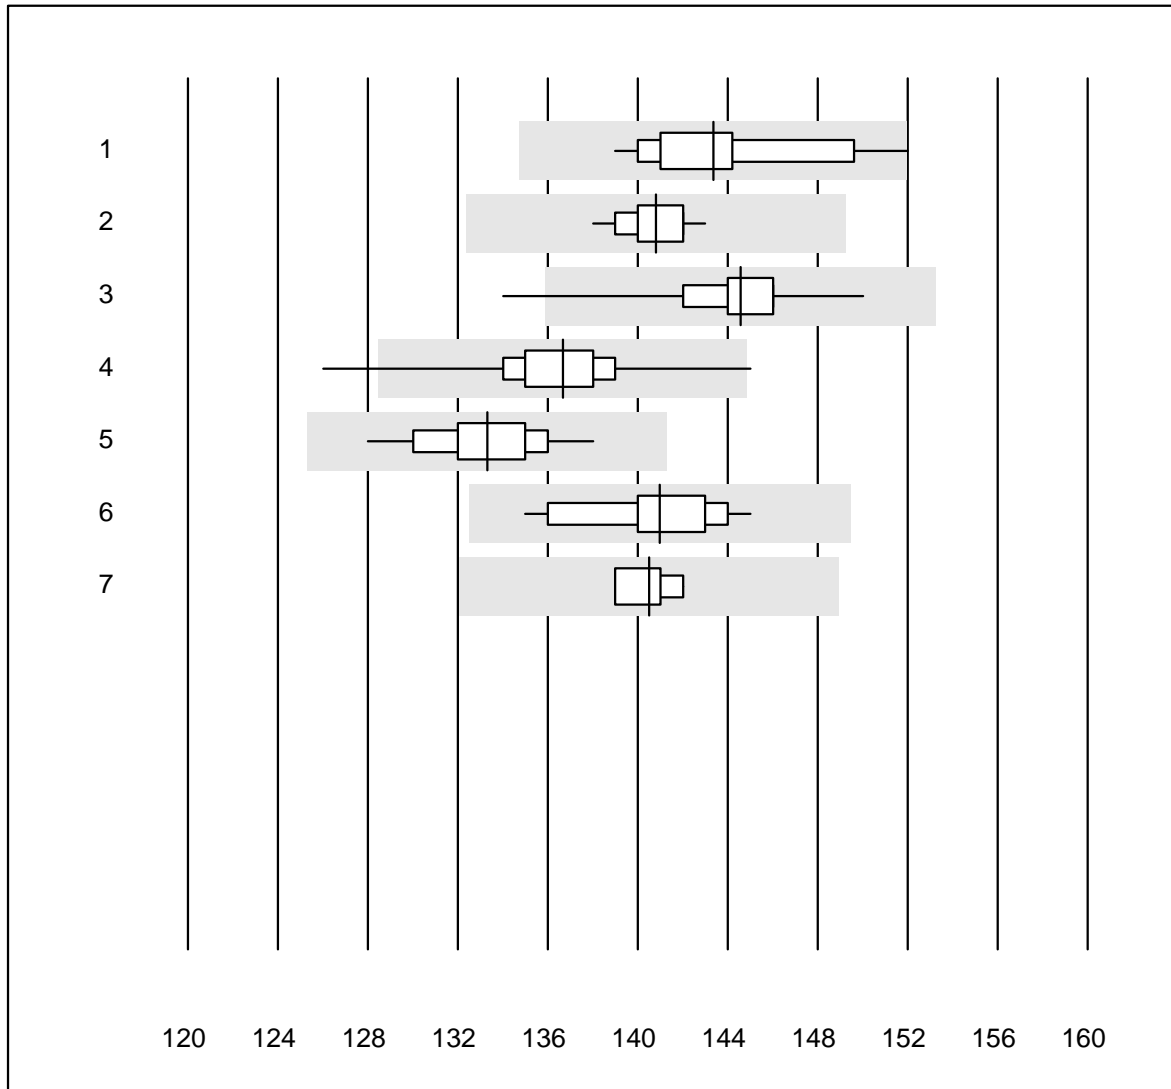


QUALAB Tolérance : 6 %

Sodium (mmol/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 ISE	39	97.4	2.6	0.0	143	2.1	e
2 Cobas	21	100.0	0.0	0.0	141	1.0	e
3 Fuji Dri-Chem	843	99.0	0.2	0.8	145	1.3	e
4 Spotchem D-Concept	328	99.1	0.6	0.3	137	1.5	e
5 Spotchem EL-SE 1520	64	100.0	0.0	0.0	133	1.6	e
6 Piccolo	40	100.0	0.0	0.0	141	1.8	e
7 iStat Chem8	6	100.0	0.0	0.0	141	0.9	e

Phosphates

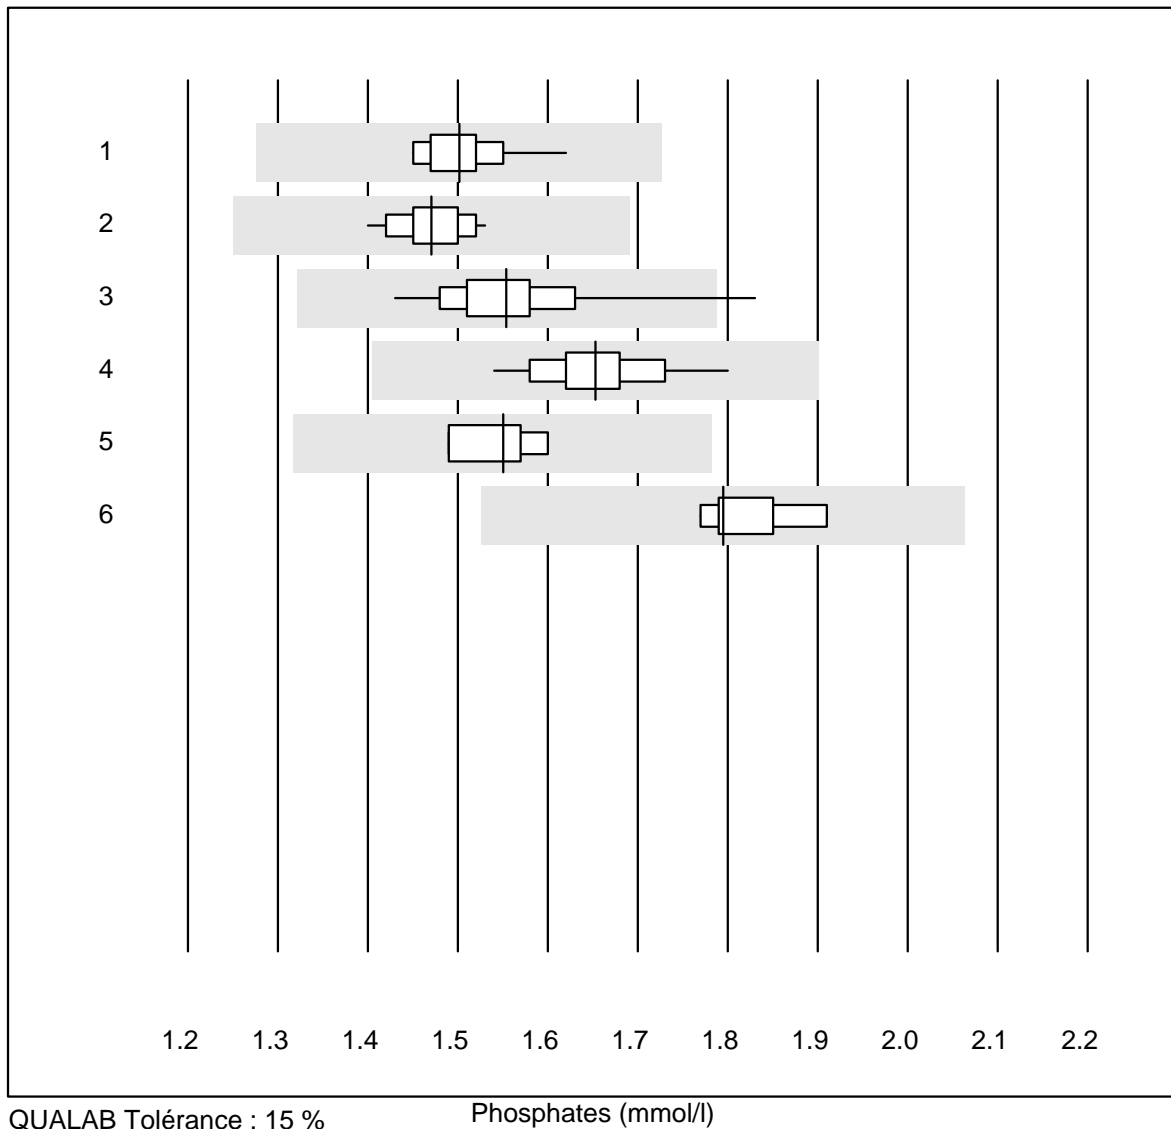


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Chimie humide	23	100.0	0.0	0.0	1.5	2.8	e
2 Cobas	18	100.0	0.0	0.0	1.5	2.5	e
3 Fuji Dri-Chem	86	97.6	1.2	1.2	1.6	4.5	e
4 Spotchem D-Concept	18	100.0	0.0	0.0	1.7	3.5	e
5 Spotchem/Ready	4	100.0	0.0	0.0	1.6	3.1	e
6 Piccolo	6	100.0	0.0	0.0	1.8	2.9	e

Protéine

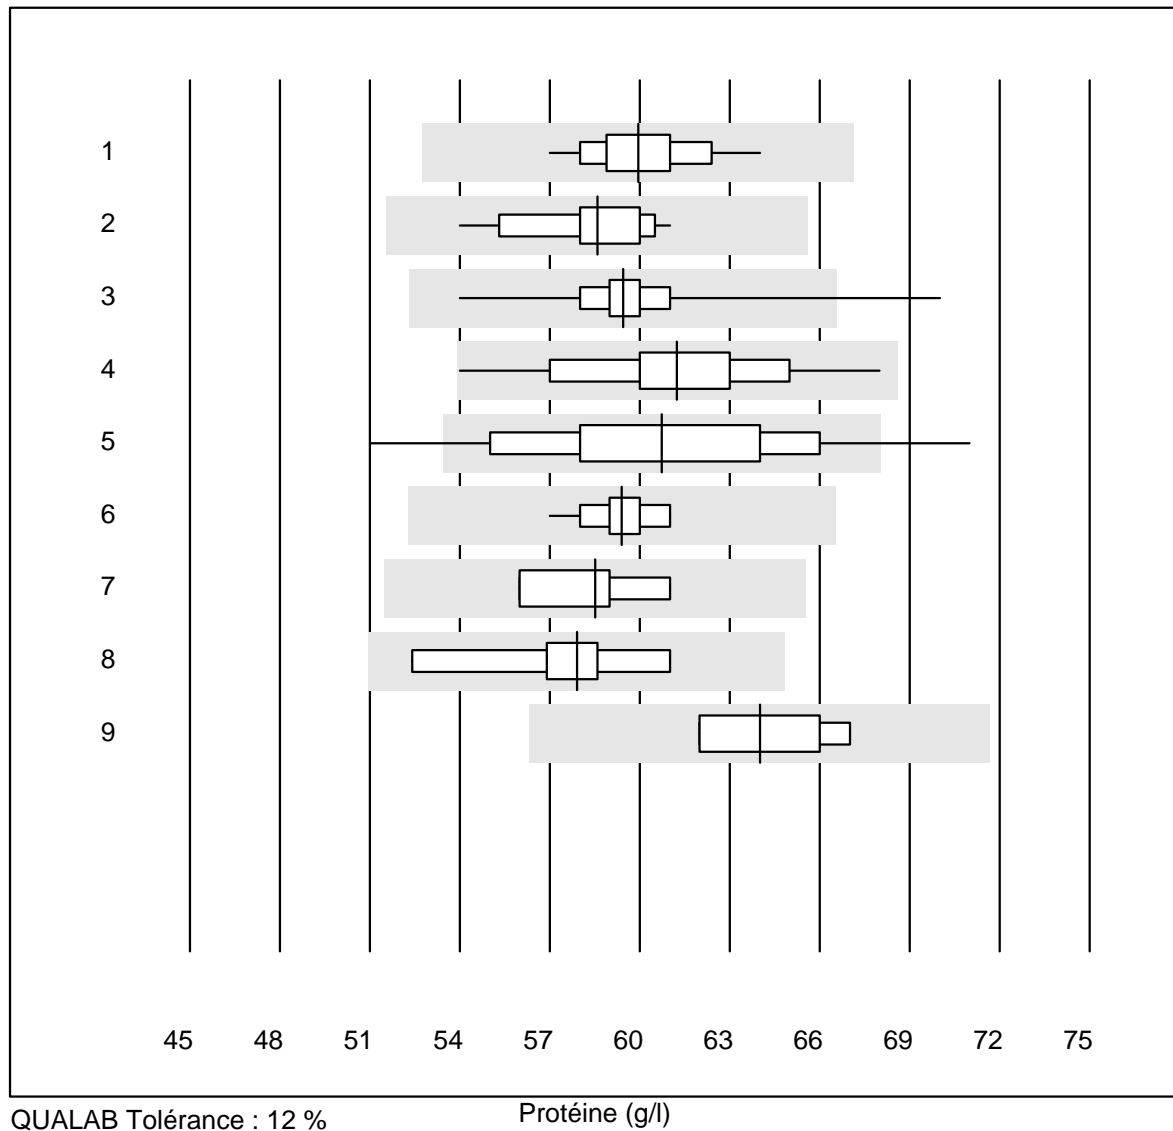

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Chimie humide	23	100.0	0.0	0.0	59.9	2.8	e
2 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	58.6	3.4	e
3 Fuji Dri-Chem	182	98.4	0.5	1.1	59.5	2.9	e
4 Spotchem/Ready	26	96.2	0.0	3.8	61.2	5.4	e
5 Spotchem D-Concept	133	91.7	5.3	3.0	60.7	6.5	e
6 Piccolo	40	100.0	0.0	0.0	59.4	1.7	e
7 Skyla	4	100.0	0.0	0.0	58.5	3.6	e*
8 Abx Mira	5	100.0	0.0	0.0	57.9	5.5	e*
9 Hitachi S40/M40	6	100.0	0.0	0.0	64.0	3.3	e

Transaminase GOT/AST

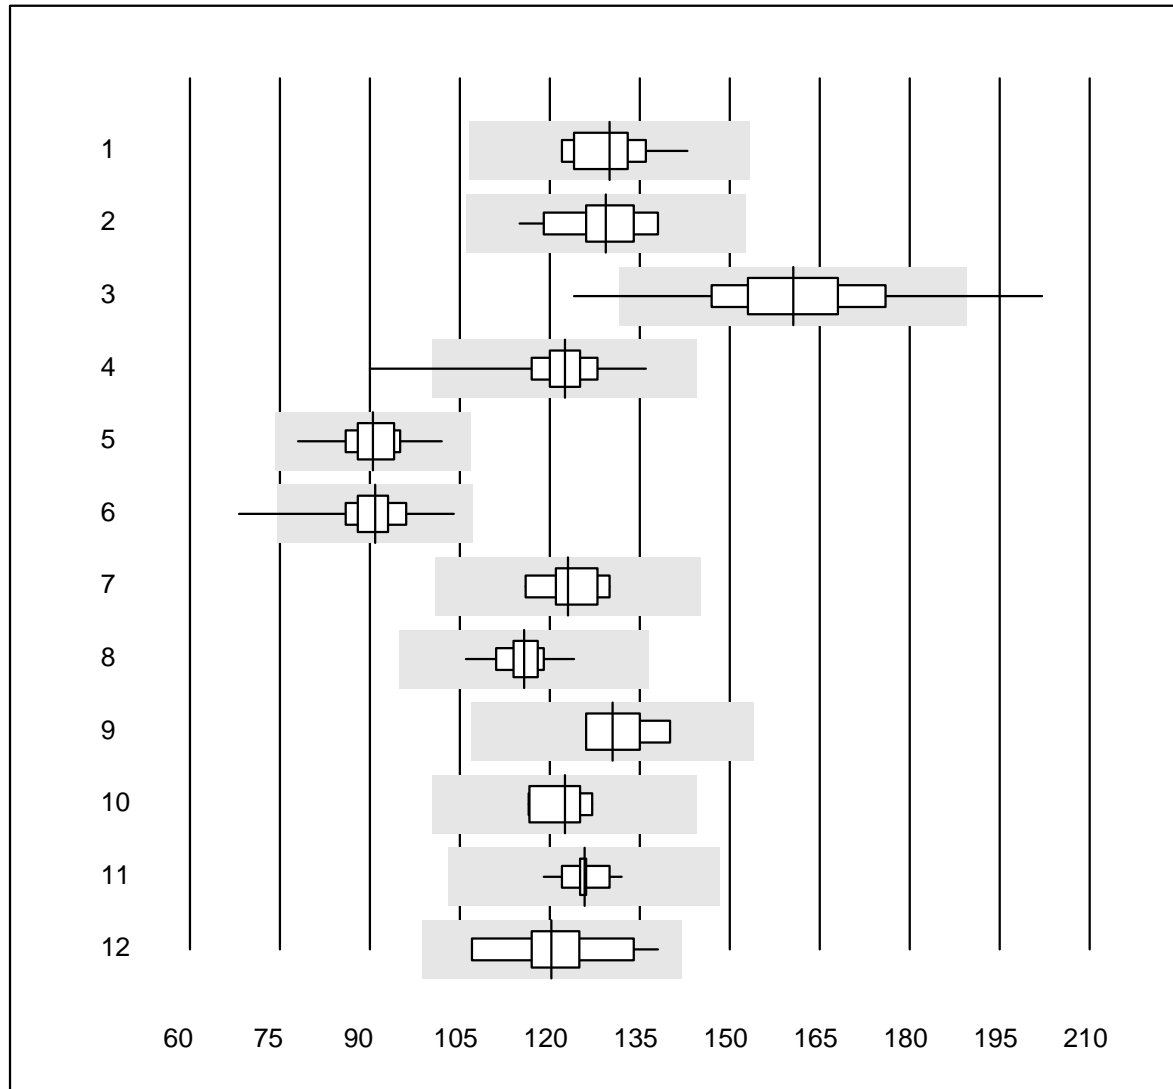


QUALAB Tolérance : 18 %

Transaminase GOT/AST (U/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 IFCC avec PP	28	100.0	0.0	0.0	130	4.2	e
2 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	129	5.2	e
3 Reflotron	578	95.7	2.4	1.9	161	7.4	e
4 Fuji Dri-Chem	918	99.3	0.4	0.3	122	3.9	e
5 Spotchem/Ready	82	100.0	0.0	0.0	91	4.5	e
6 Spotchem D-Concept	372	99.4	0.3	0.3	91	4.7	e
7 IFCC sens PP	5	100.0	0.0	0.0	123	4.5	e
8 Piccolo	62	100.0	0.0	0.0	116	3.0	e
9 Skyla	4	100.0	0.0	0.0	131	5.3	e*
10 Abx Mira	8	100.0	0.0	0.0	123	3.3	e
11 Hitachi S40/M40	14	92.9	0.0	7.1	126	2.6	e
12 Autolyser/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	120	6.7	e

Transaminase GPT/ALT

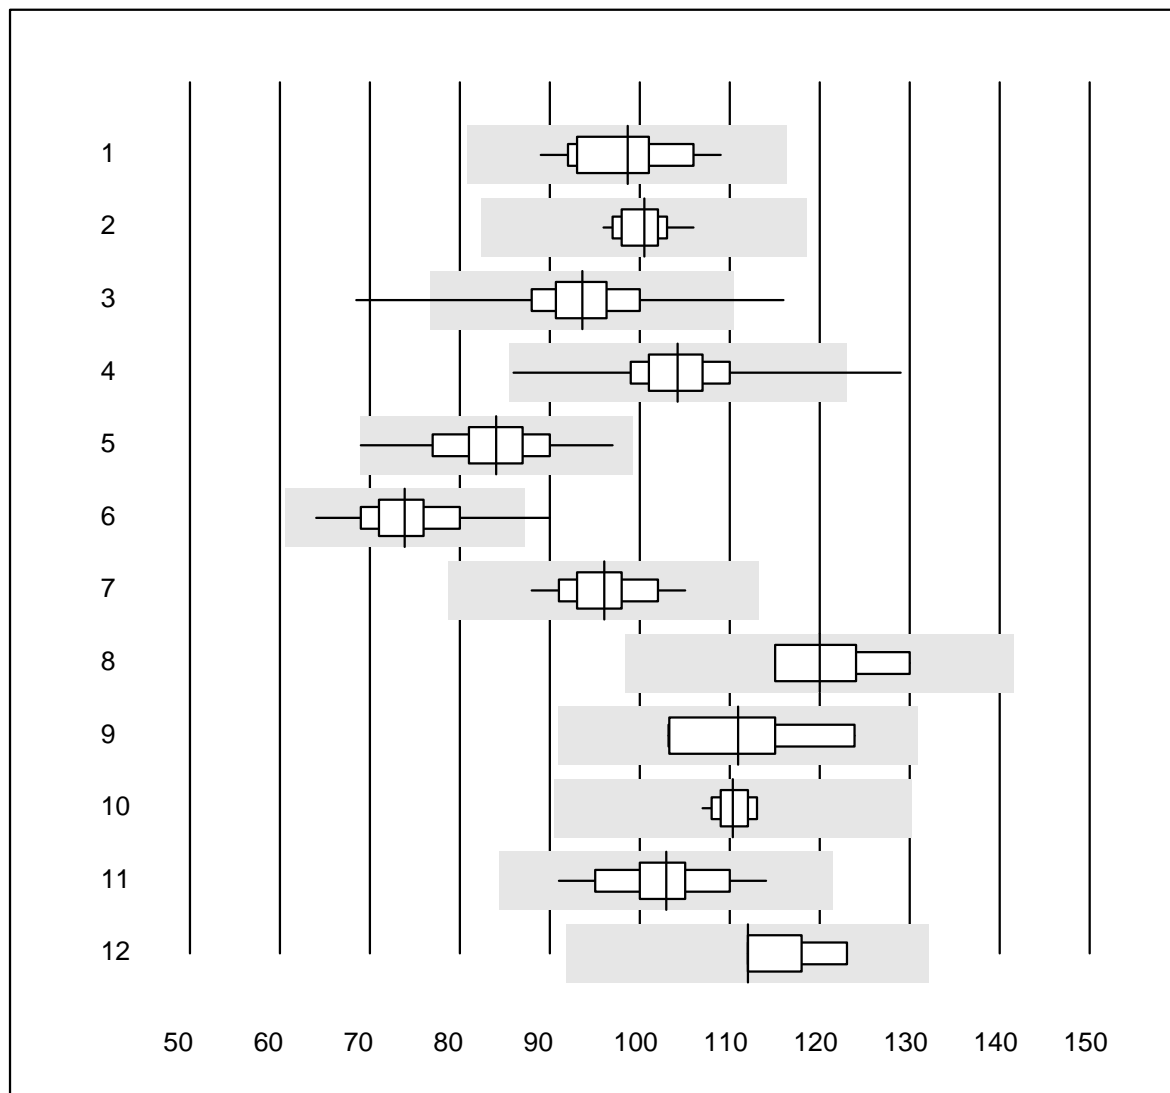


QUALAB Tolérance : 18 %

Transaminase GPT/ALT (U/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 IFCC avec PP	24	100.0	0.0	0.0	99	5.4	e
2 Cobas	22	100.0	0.0	0.0	100	2.5	e
3 Reflotron	598	97.2	1.3	1.5	94	5.9	e
4 Fuji Dri-Chem	931	99.0	0.4	0.6	104	4.9	e
5 Spotchem/Ready	84	100.0	0.0	0.0	84	6.8	e
6 Spotchem D-Concept	375	99.2	0.3	0.5	74	6.0	e
7 Piccolo	61	98.4	0.0	1.6	96	4.1	e
8 Skyla	4	100.0	0.0	0.0	120	5.8	e*
9 Abx Mira	7	100.0	0.0	0.0	111	6.7	e*
10 Hitachi S40/M40	15	93.3	0.0	6.7	110	1.8	e
11 Autolyser/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	103	5.4	e
12 Autres méthodes	5	100.0	0.0	0.0	112	4.3	e

Triglycérides

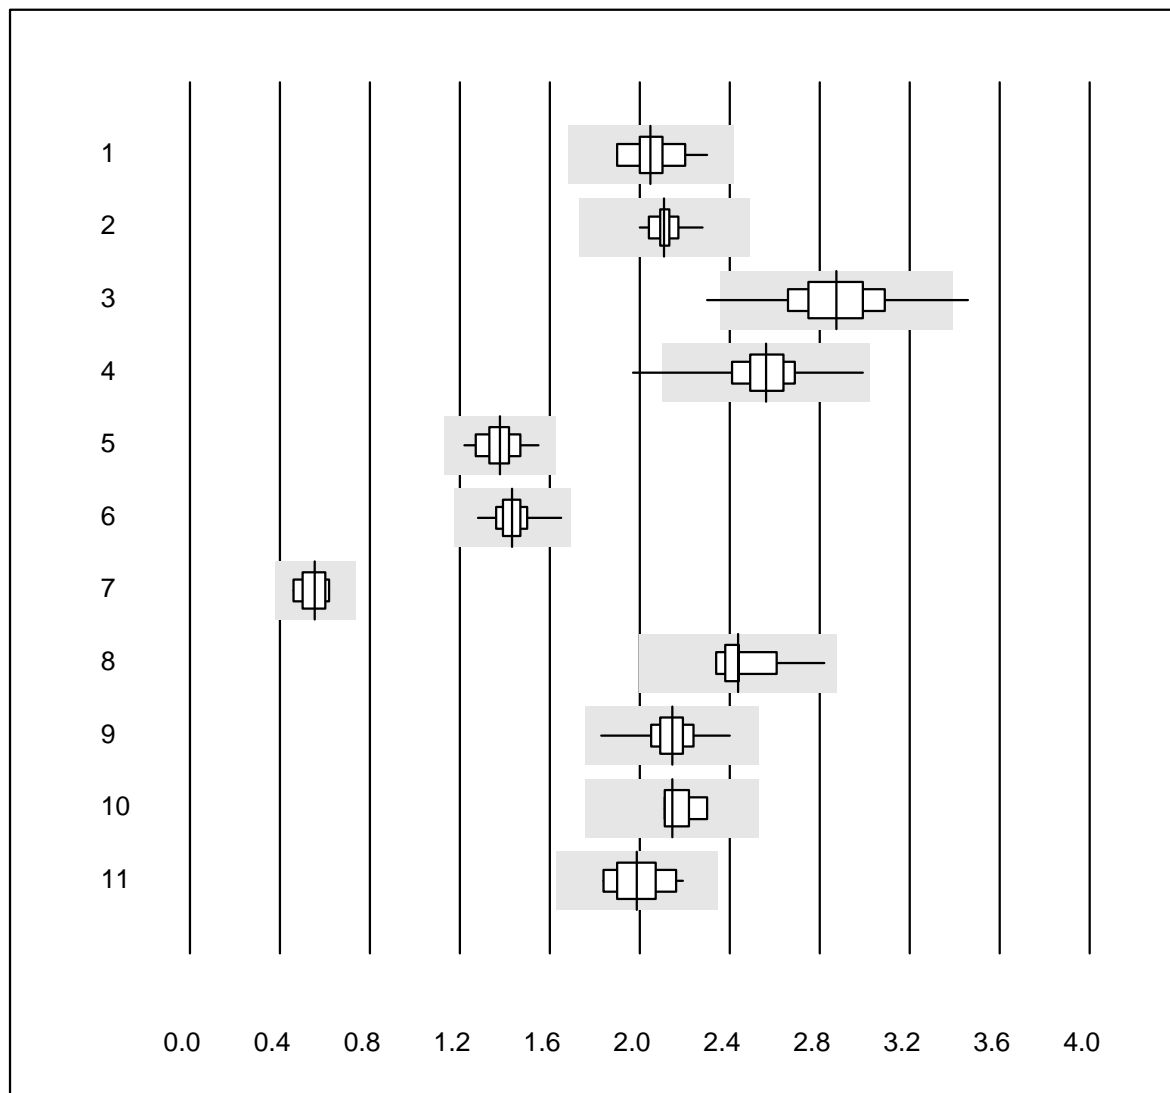


QUALAB Tolérance : 18 %
(< 1.00: +/- 0.18 mmol/l)

Triglycérides (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Chimie humide	27	96.3	0.0	3.7	2.05	5.5	e
2 Cobas	21	100.0	0.0	0.0	2.11	2.8	e
3 Reflotron	277	96.8	1.8	1.4	2.87	6.2	e
4 Fuji Dri-Chem	808	99.4	0.2	0.4	2.56	4.5	e
5 Spotchem/Ready	68	100.0	0.0	0.0	1.38	5.4	e
6 Spotchem D-Concept	325	98.2	0.0	1.8	1.43	4.2	e
7 Hitachi S40/M40	8	87.5	0.0	12.5	0.56	11.3	e*
8 Piccolo	18	100.0	0.0	0.0	2.44	4.8	e
9 Cholestech LDX	318	98.7	0.0	1.3	2.14	3.7	e
10 Abx Mira	6	100.0	0.0	0.0	2.15	3.5	e
11 Autolyser/DiaSys	18	100.0	0.0	0.0	1.99	5.2	e

Lithium

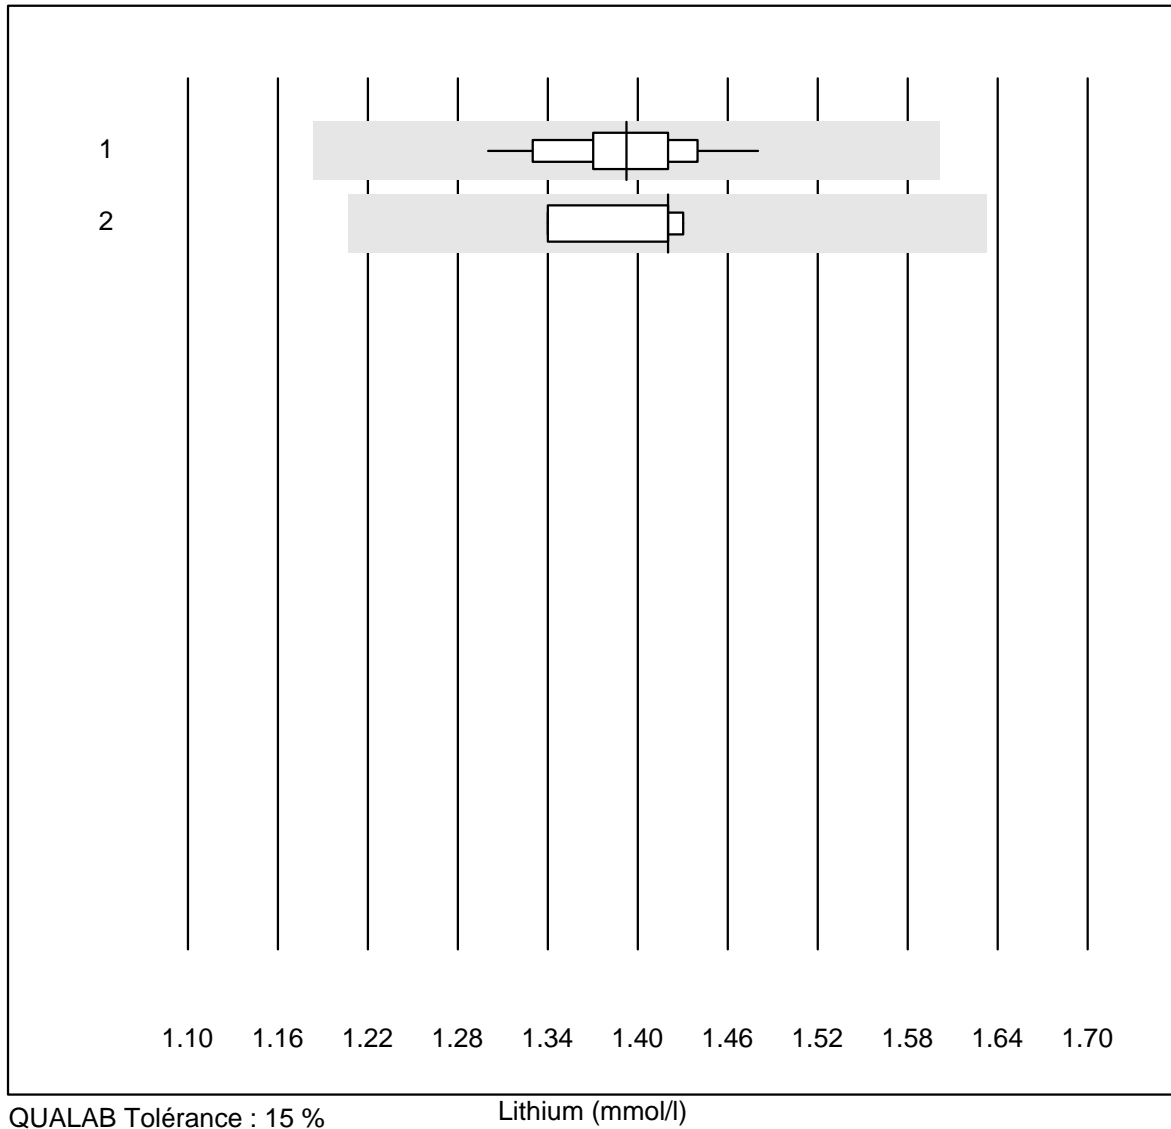


QUALAB Tolérance : 15 %

Lithium (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	18	100.0	0.0	0.0	1.39	3.1	e
2 Cobas Integra 800/40	4	100.0	0.0	0.0	1.42	3.0	e

Laktat

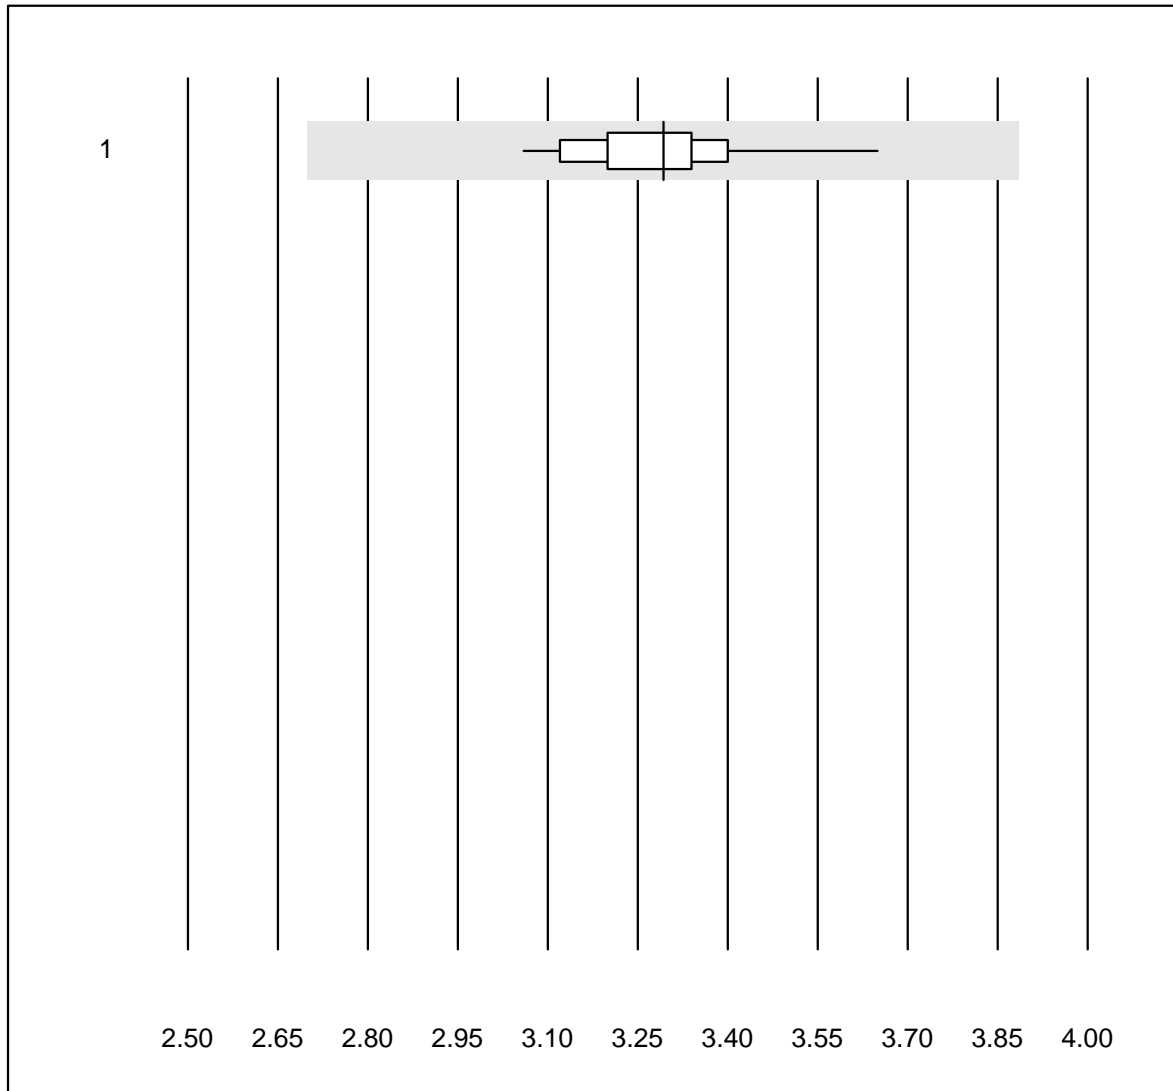


QUALAB Tolérance : 18 %

Laktat (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	13	100.0	0.0	0.0	3.29	4.5	e

HbA1c échantillon A

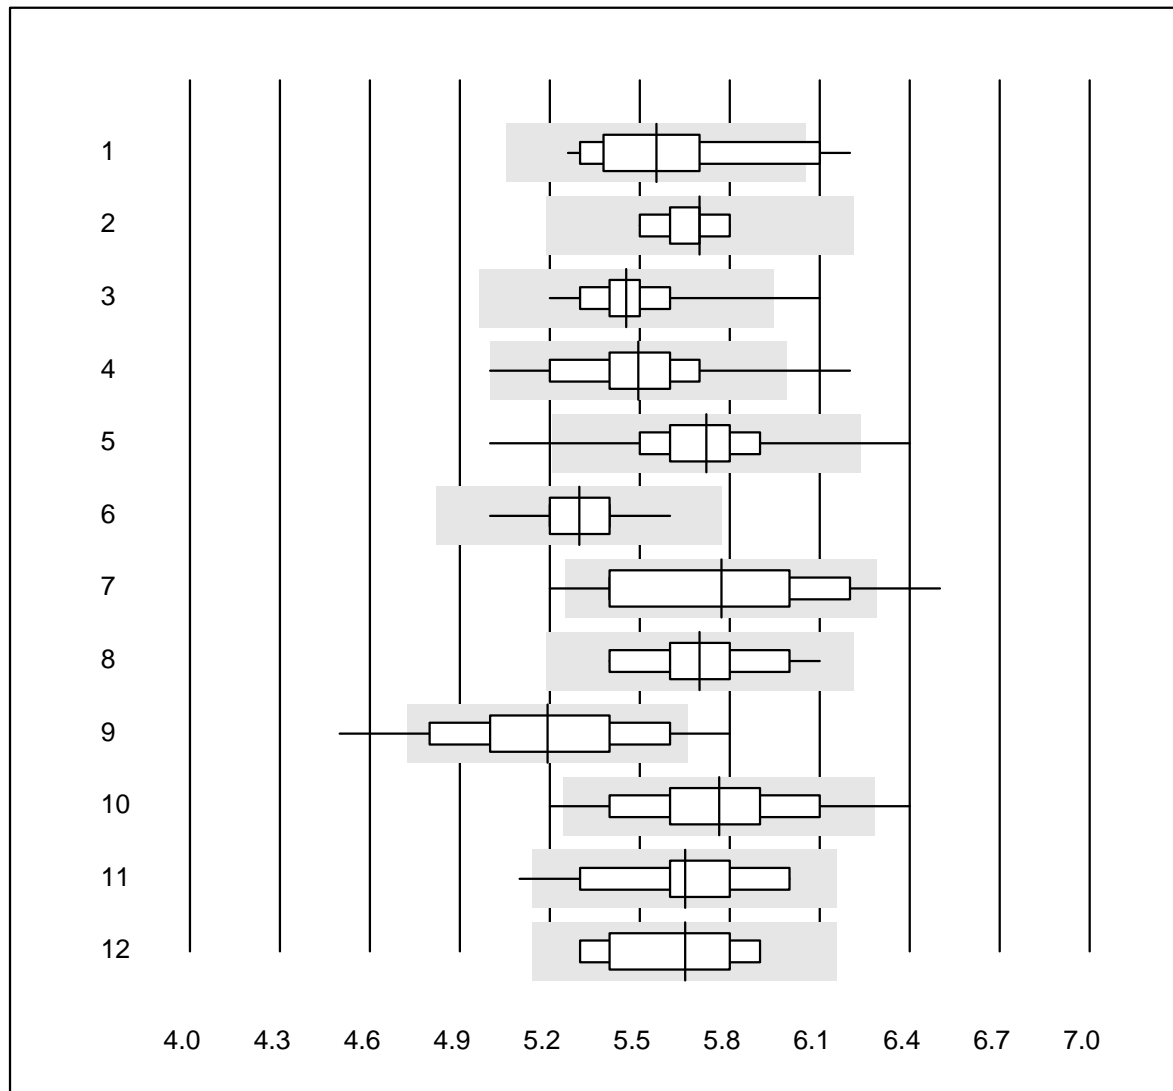


QUALAB Tolérance : 9 %

HbA1c échantillon A (%)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Roche, Cobas	17	88.2	11.8	0.0	5.6	5.1	e*
2 HPLC	7	100.0	0.0	0.0	5.7	1.7	e
3 Afinion	557	98.0	1.8	0.2	5.5	2.5	e
4 Cobas b101	138	98.6	1.4	0.0	5.5	3.6	e
5 DCA2000/Vantage	152	96.7	1.3	2.0	5.7	3.3	e
6 Celltac chemi	21	100.0	0.0	0.0	5.3	2.6	e
7 NycoCard	22	86.4	13.6	0.0	5.8	6.1	e*
8 Eurolyser	10	100.0	0.0	0.0	5.7	4.0	e*
9 A1c Now	213	79.8	12.7	7.5	5.2	5.7	e
10 AFIAS	52	96.2	3.8	0.0	5.8	4.6	e
11 Andere	19	89.4	5.3	5.3	5.7	4.1	a
12 Spinit	8	100.0	0.0	0.0	5.7	3.7	e*

HbA1c échantillon B

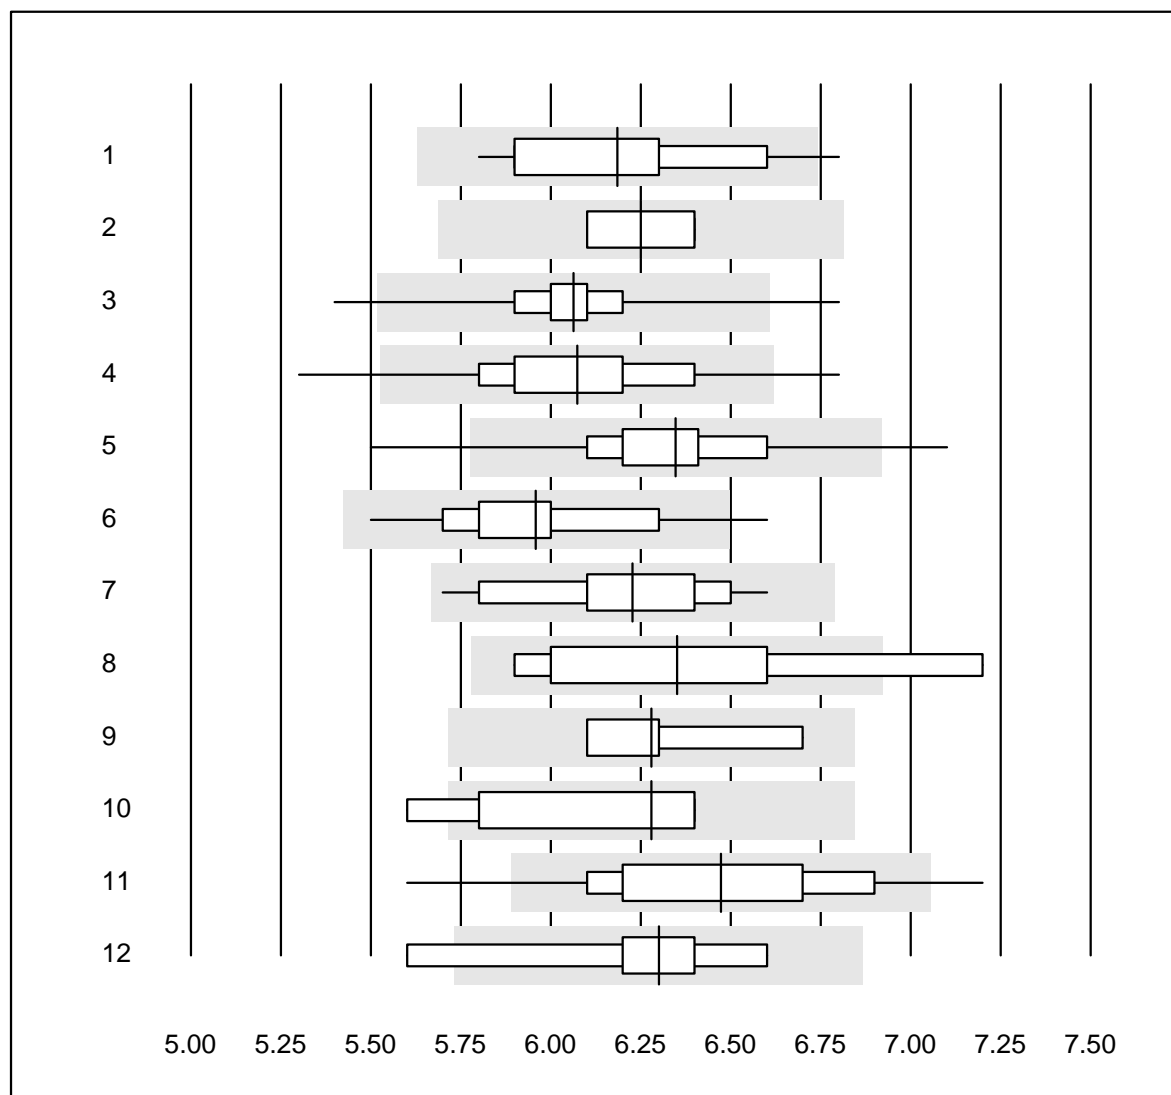


QUALAB Tolérance : 9 %

HbA1c échantillon B (%)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Roche, Cobas	16	93.7	6.3	0.0	6.2	4.5	e*
2 HPLC	7	100.0	0.0	0.0	6.3	2.0	e
3 Afinion	777	98.5	0.6	0.9	6.1	2.3	e
4 Cobas b101	152	94.7	3.3	2.0	6.1	4.0	e
5 DCA2000/Vantage	219	97.2	2.3	0.5	6.3	3.2	e
6 Celltac chemi	17	94.1	5.9	0.0	6.0	4.3	e
7 NycoCard	11	100.0	0.0	0.0	6.2	4.5	e*
8 Eurolyser	8	87.5	12.5	0.0	6.4	6.8	e*
9 Hemocue HbA1c 501	4	100.0	0.0	0.0	6.3	4.2	a
10 A1c Now	8	62.5	12.5	25.0	6.3	5.5	a
11 AFIAS	77	90.9	5.2	3.9	6.5	5.1	e
12 Spinit	9	88.9	11.1	0.0	6.3	4.5	e*
13 Andere	15	100.0	0.0	0.0	6.3	5.0	a

pCO2

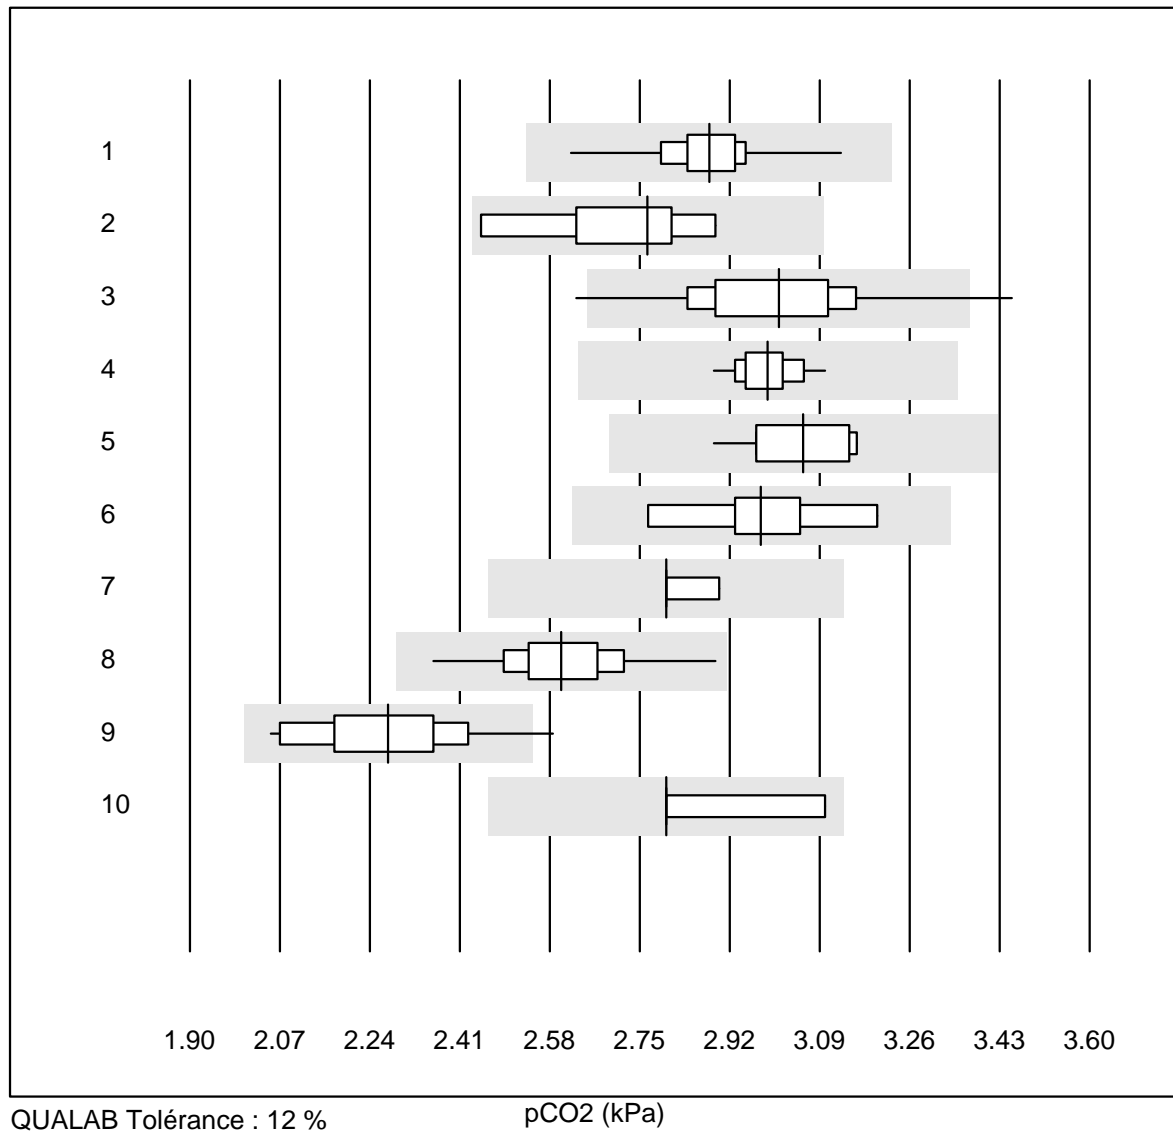

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1	ABL700/800	95	98.9	0.0	1.1	2.88	2.7	e
2	ABL80 FLEX	8	87.5	0.0	12.5	2.76	5.4	e*
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	16	81.2	12.5	6.3	3.01	6.0	e*
4	ABL90 FLEX / PLUS	80	100.0	0.0	0.0	2.99	1.7	e
5	Cobas b 123	14	100.0	0.0	0.0	3.06	3.0	e
6	Cobas b 221	7	100.0	0.0	0.0	2.98	4.4	e*
7	GEM	5	100.0	0.0	0.0	2.80	1.6	e
8	iStat	42	97.6	0.0	2.4	2.60	4.2	e
9	EPOC	49	93.9	2.0	4.1	2.27	5.8	e
10	IL	4	100.0	0.0	0.0	2.80	5.2	e*


pO2

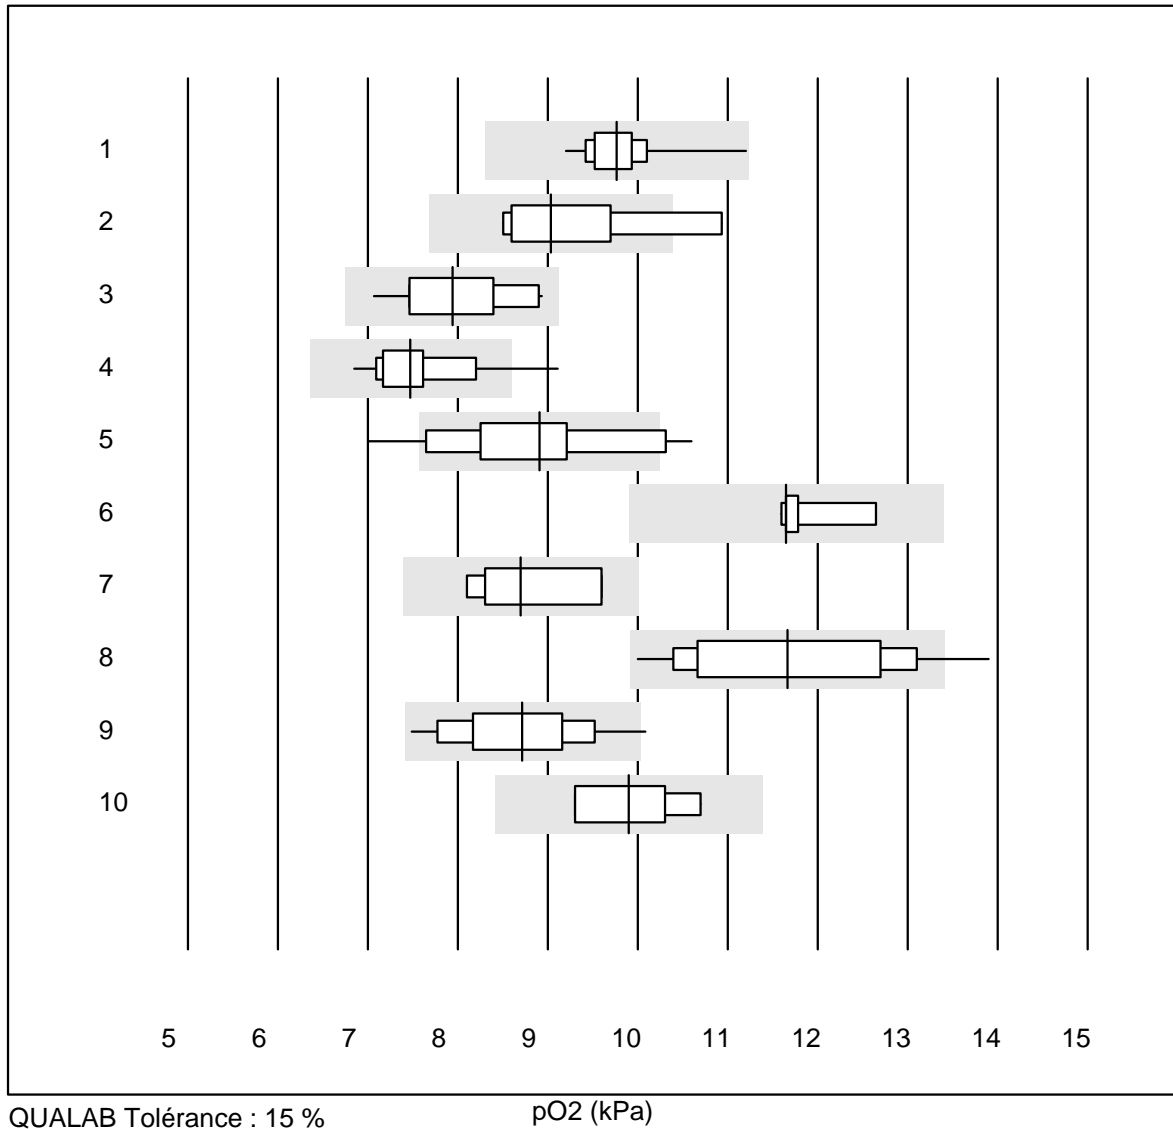

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1	ABL700/800	94	93.6	0.0	6.4	9.76	3.2	e
2	ABL80 FLEX	8	87.5	12.5	0.0	9.03	8.6	e*
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	16	81.2	0.0	18.8	7.94	7.7	e*
4	ABL90 FLEX / PLUS	81	87.7	3.7	8.6	7.47	6.3	e
5	Cobas b 123	14	64.3	21.4	14.3	8.91	11.7	e*
6	Cobas b 221	7	71.4	0.0	28.6	11.65	3.6	e
7	GEM	5	100.0	0.0	0.0	8.70	8.0	e*
8	iStat	40	92.5	5.0	2.5	11.66	9.5	e
9	EPOC	49	83.7	2.0	14.3	8.71	7.6	e
10	IL	4	100.0	0.0	0.0	9.90	6.6	e*

K04 Gaz sanguis

pH

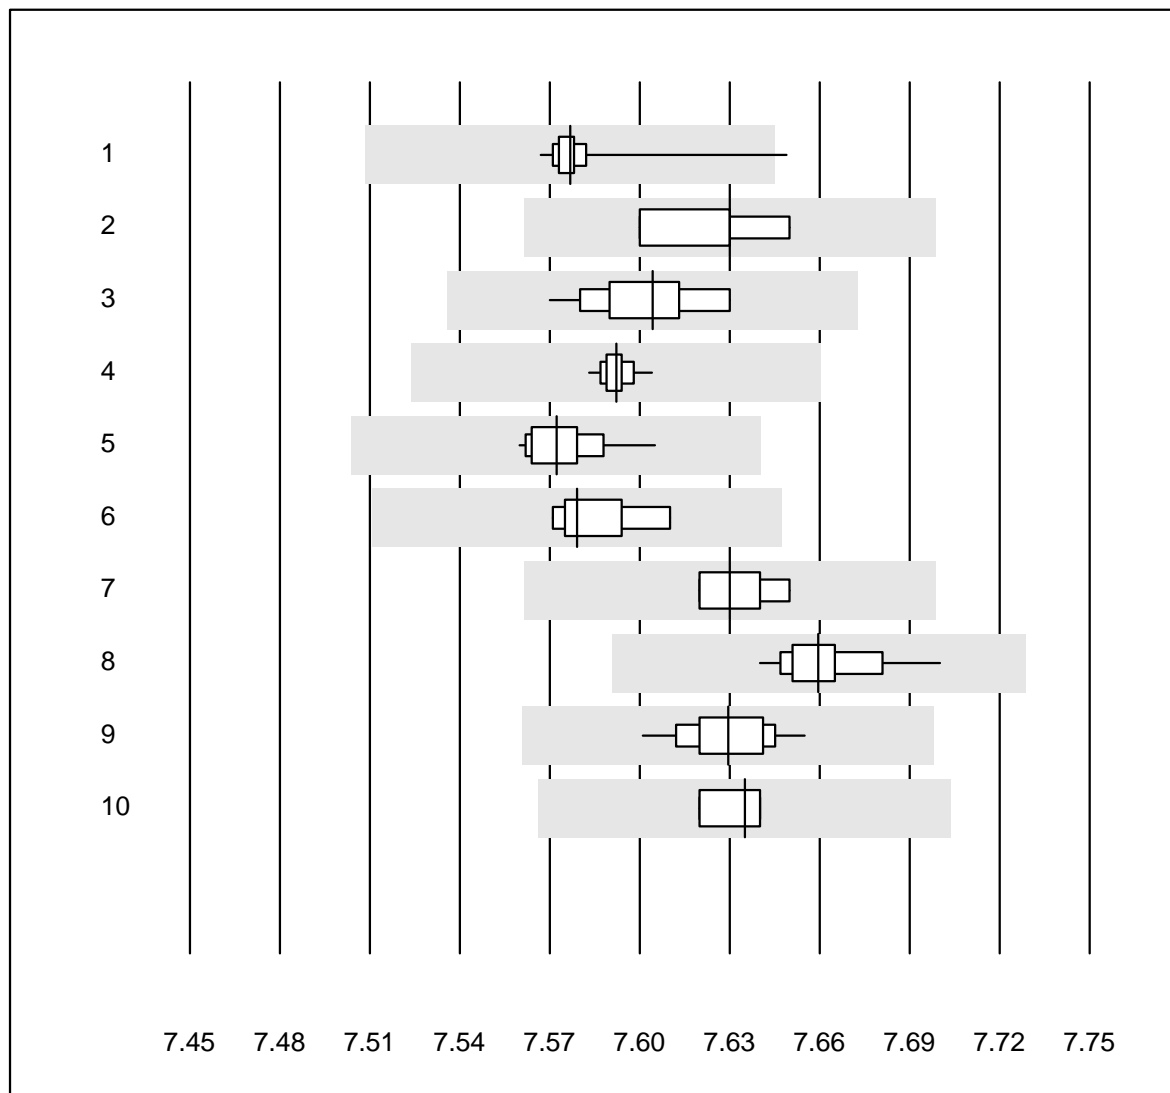


QUALAB Tolérance : 1 %

pH ()

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 ABL700/800	94	98.9	1.1	0.0	7.58	0.1	e
2 ABL80 FLEX	8	100.0	0.0	0.0	7.63	0.2	e
3 ABL80 FLEX CO-OX / O	15	100.0	0.0	0.0	7.60	0.2	e
4 ABL90 FLEX / PLUS	81	100.0	0.0	0.0	7.59	0.1	e
5 Cobas b 123	14	100.0	0.0	0.0	7.57	0.2	e
6 Cobas b 221	7	100.0	0.0	0.0	7.58	0.2	e
7 GEM	5	100.0	0.0	0.0	7.63	0.2	e
8 iStat	43	100.0	0.0	0.0	7.66	0.2	e
9 EPOC	48	100.0	0.0	0.0	7.63	0.2	e
10 IL	4	100.0	0.0	0.0	7.64	0.1	e

Glucose GS

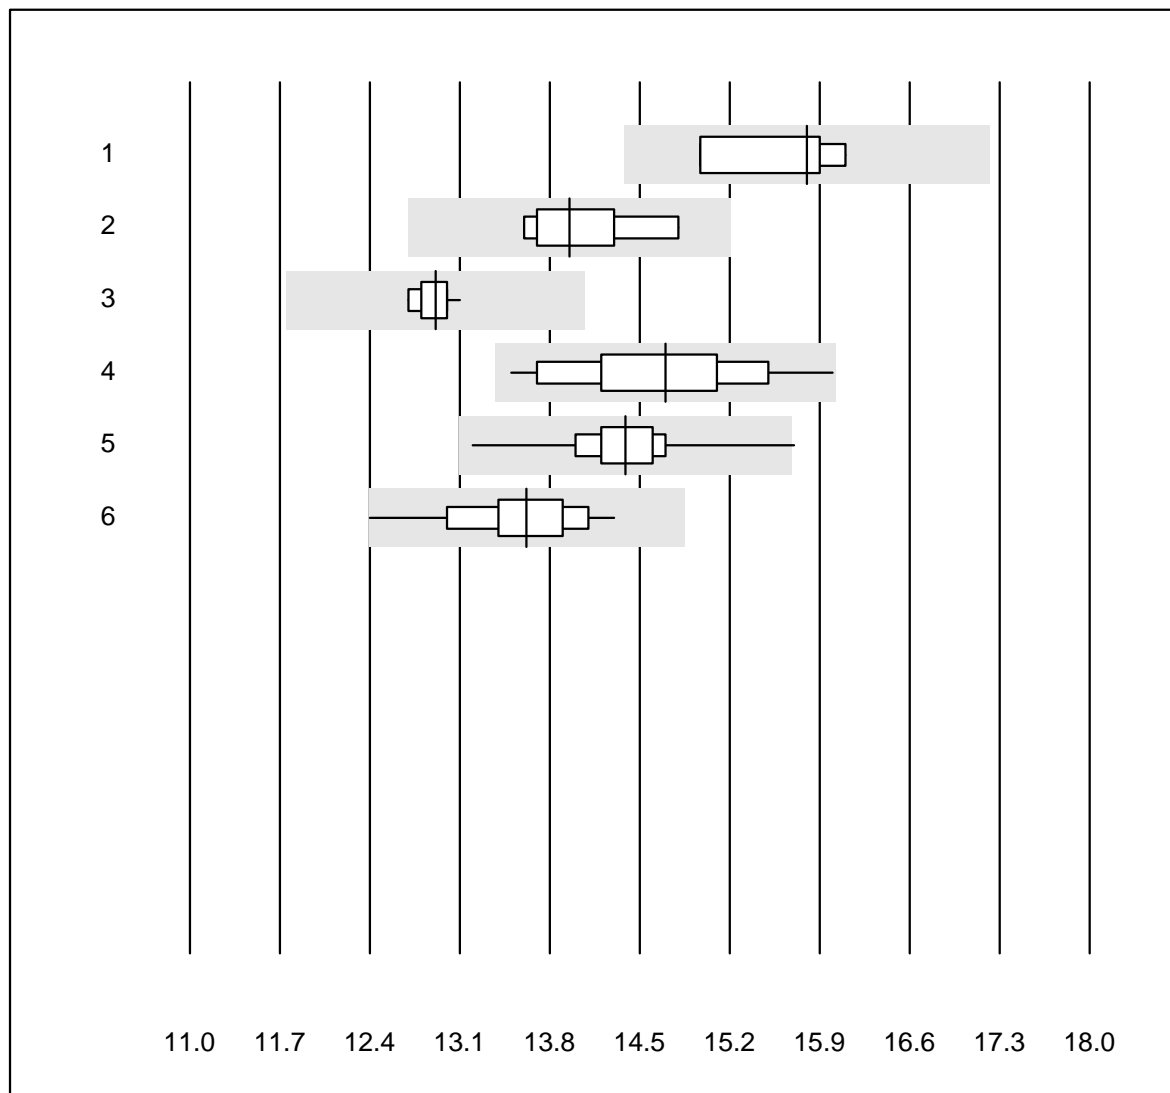


QUALAB Tolérance : 9 %

Glucose GS (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas b 221	5	80.0	0.0	20.0	15.8	3.2	e*
2 Cobas b 123	8	100.0	0.0	0.0	14.0	2.8	e
3 iStat	11	100.0	0.0	0.0	12.9	1.1	e
4 EPOC	36	100.0	0.0	0.0	14.7	4.2	e
5 ABL700/800	87	98.9	1.1	0.0	14.4	2.4	e
6 ABL90 FLEX / PLUS	79	100.0	0.0	0.0	13.6	3.0	e

Hémoglobine BG

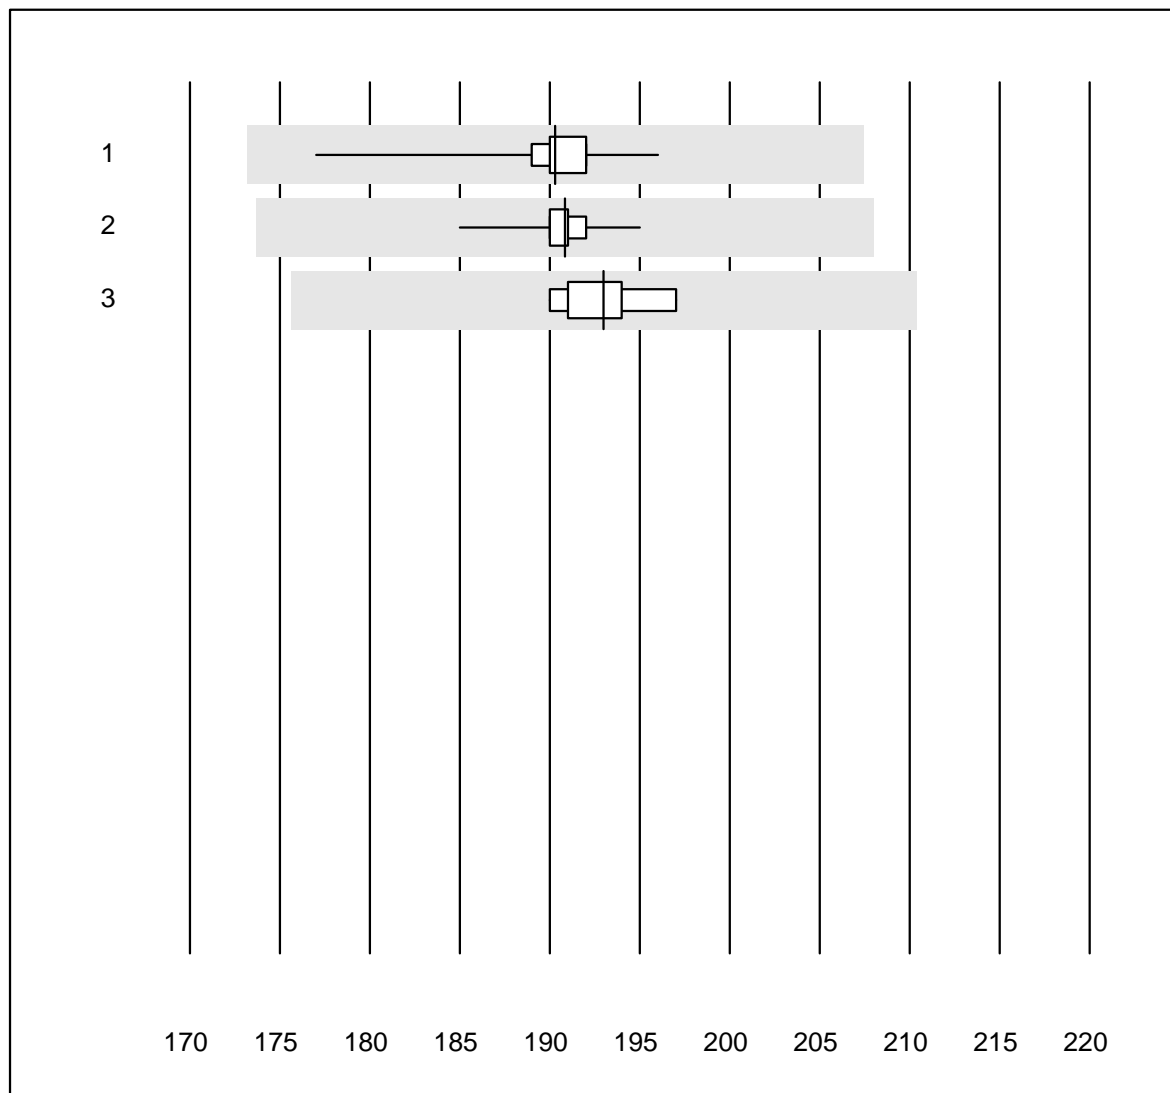


QUALAB Tolérance : 9 %

Hémoglobine BG (g/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 ABL700/800	88	100.0	0.0	0.0	190.3	1.7	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	76	98.7	0.0	1.3	190.8	0.5	e
3 ABL80 FLEX CO-OX / O	12	100.0	0.0	0.0	193.0	1.3	e

Potassium BG

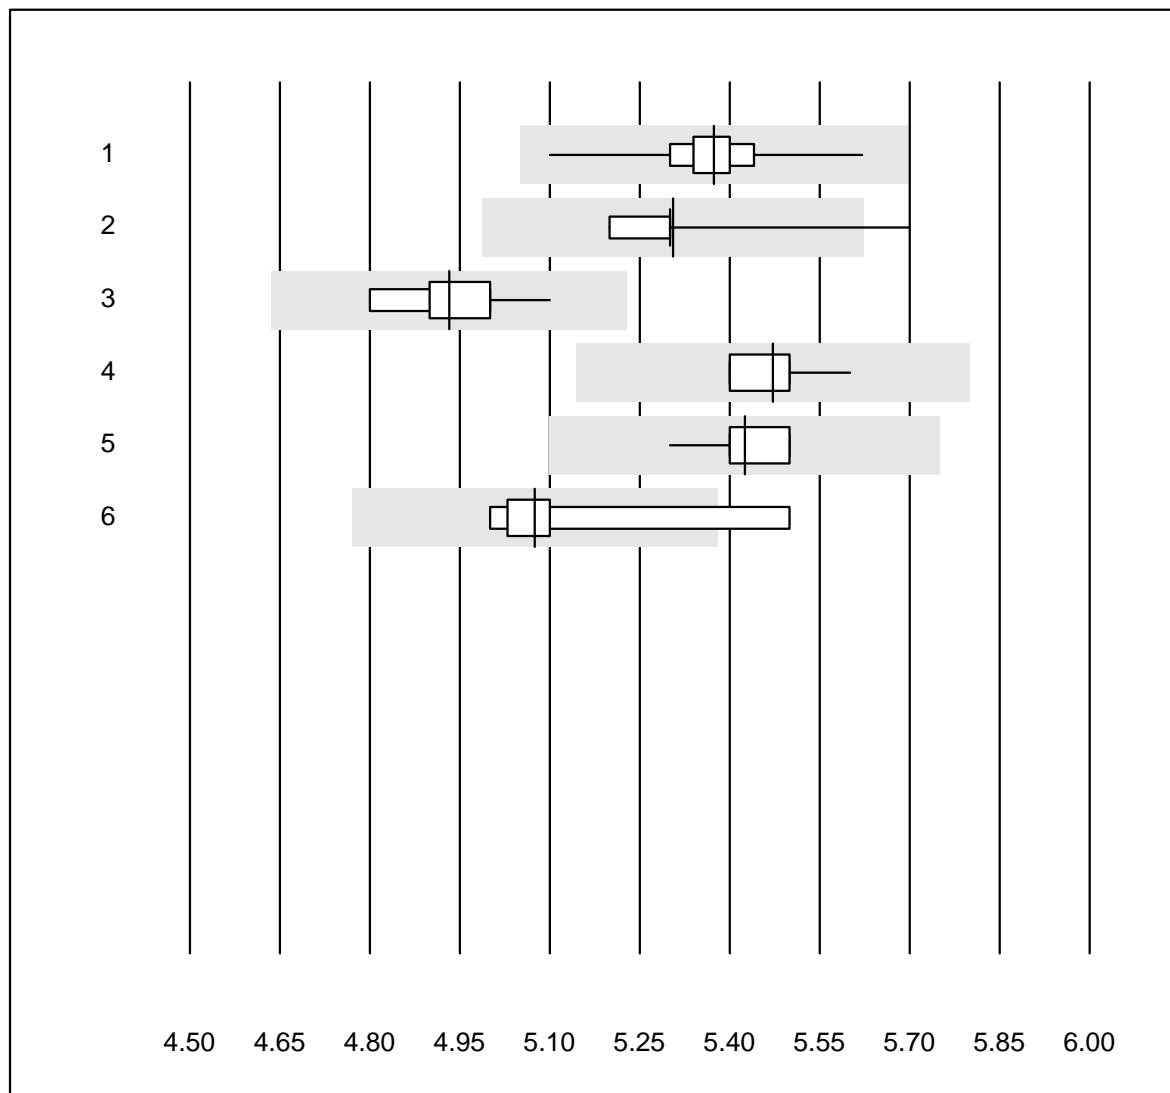


QUALAB Tolérance : 6 %

Potassium BG (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas b 123	18	100.0	0.0	0.0	5.4	1.8	e
2 iStat	20	95.0	5.0	0.0	5.3	1.9	e
3 EPOC	41	97.6	0.0	2.4	4.9	1.7	e
4 ABL700/800	88	98.9	0.0	1.1	5.5	1.0	e
5 ABL90 FLEX / PLUS	81	100.0	0.0	0.0	5.4	0.9	e
6 ABL80 FLEX CO-OX / O	8	87.5	12.5	0.0	5.1	3.1	e*

Sodium BG

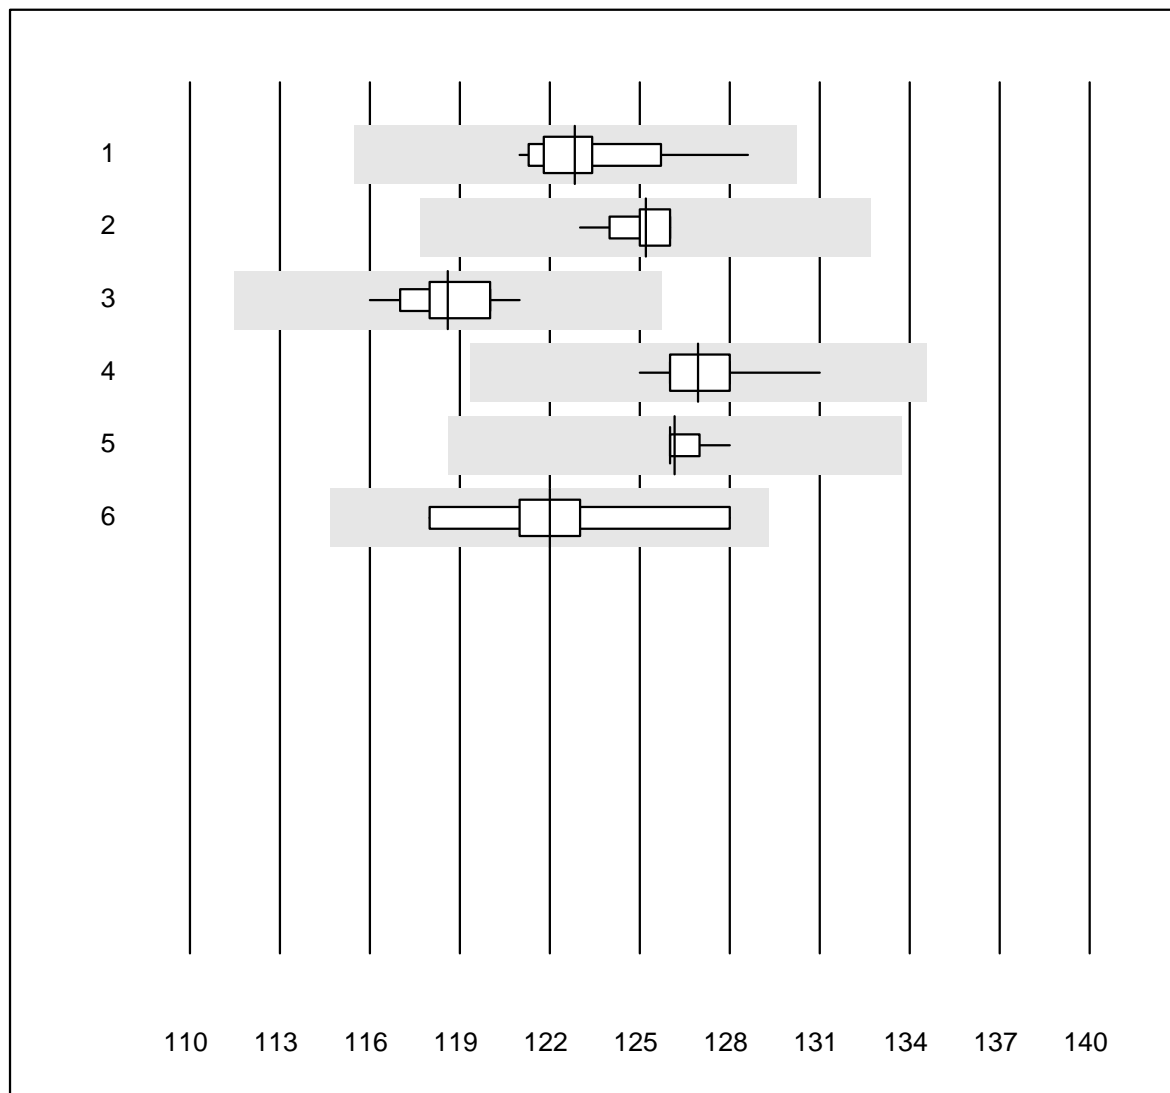


QUALAB Tolérance : 6 %

Sodium BG (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas b 123	18	100.0	0.0	0.0	122.8	1.6	e
2 iStat	20	95.0	0.0	5.0	125.2	0.7	e
3 EPOC	38	100.0	0.0	0.0	118.6	1.1	e
4 ABL700/800	86	100.0	0.0	0.0	126.9	0.9	e
5 ABL90 FLEX / PLUS	80	100.0	0.0	0.0	126.2	0.3	e
6 ABL80 FLEX CO-OX / O	8	100.0	0.0	0.0	122.0	2.3	e*

Chlorure-BG

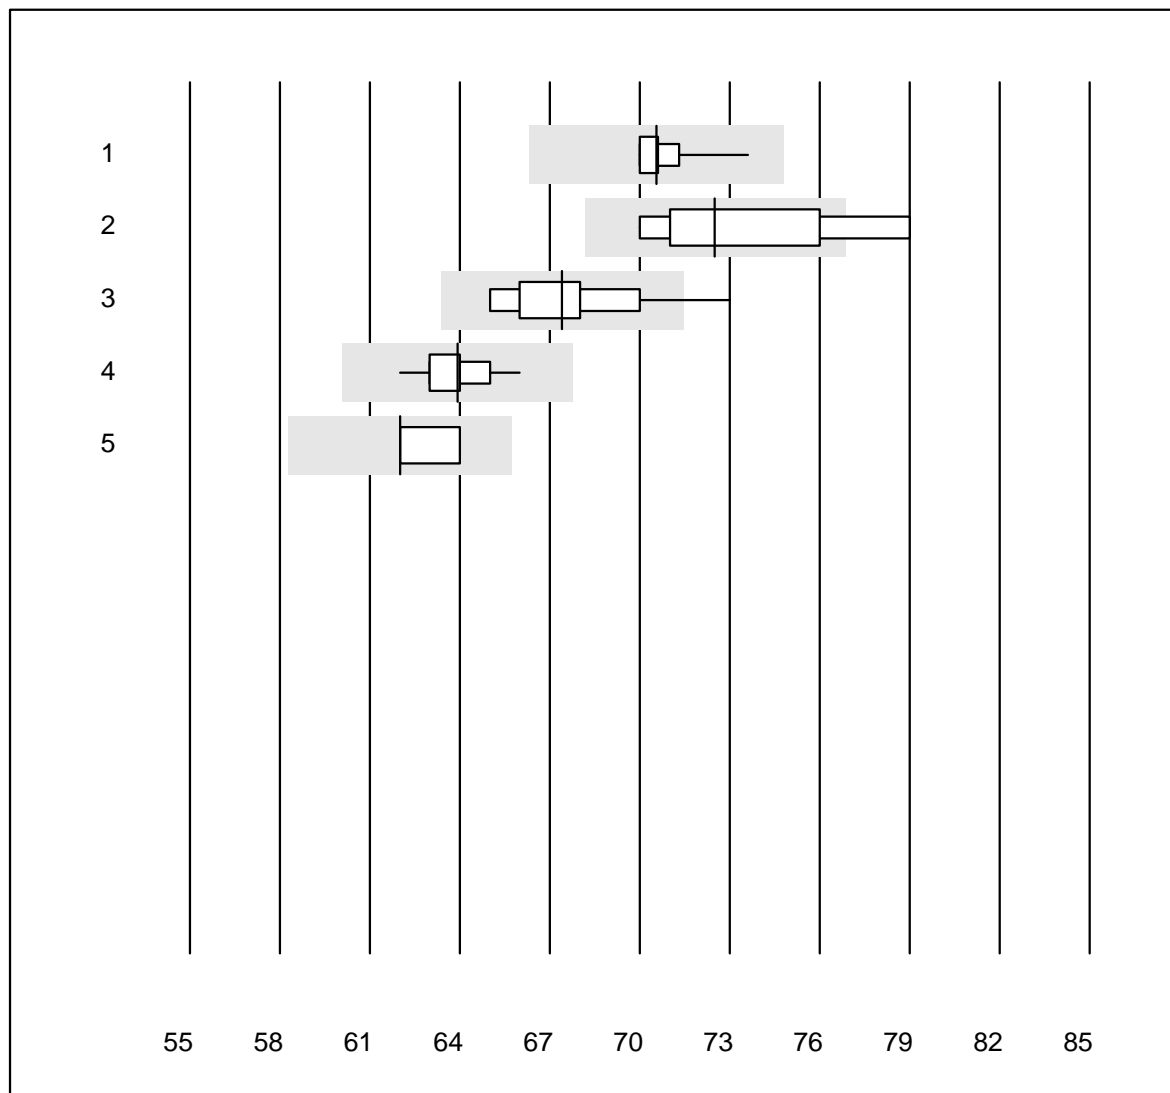


QUALAB Tolérance : 6 %

Chlorure-BG (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas b 123	11	100.0	0.0	0.0	70.6	1.5	e
2 EPOC	6	83.3	16.7	0.0	72.5	4.8	e*
3 ABL700/800	81	97.5	2.5	0.0	67.4	2.6	e
4 ABL90 FLEX / PLUS	77	100.0	0.0	0.0	63.9	1.4	e
5 ABL80 FLEX CO-OX / O	5	100.0	0.0	0.0	62.0	1.7	e*

Calcium-BG

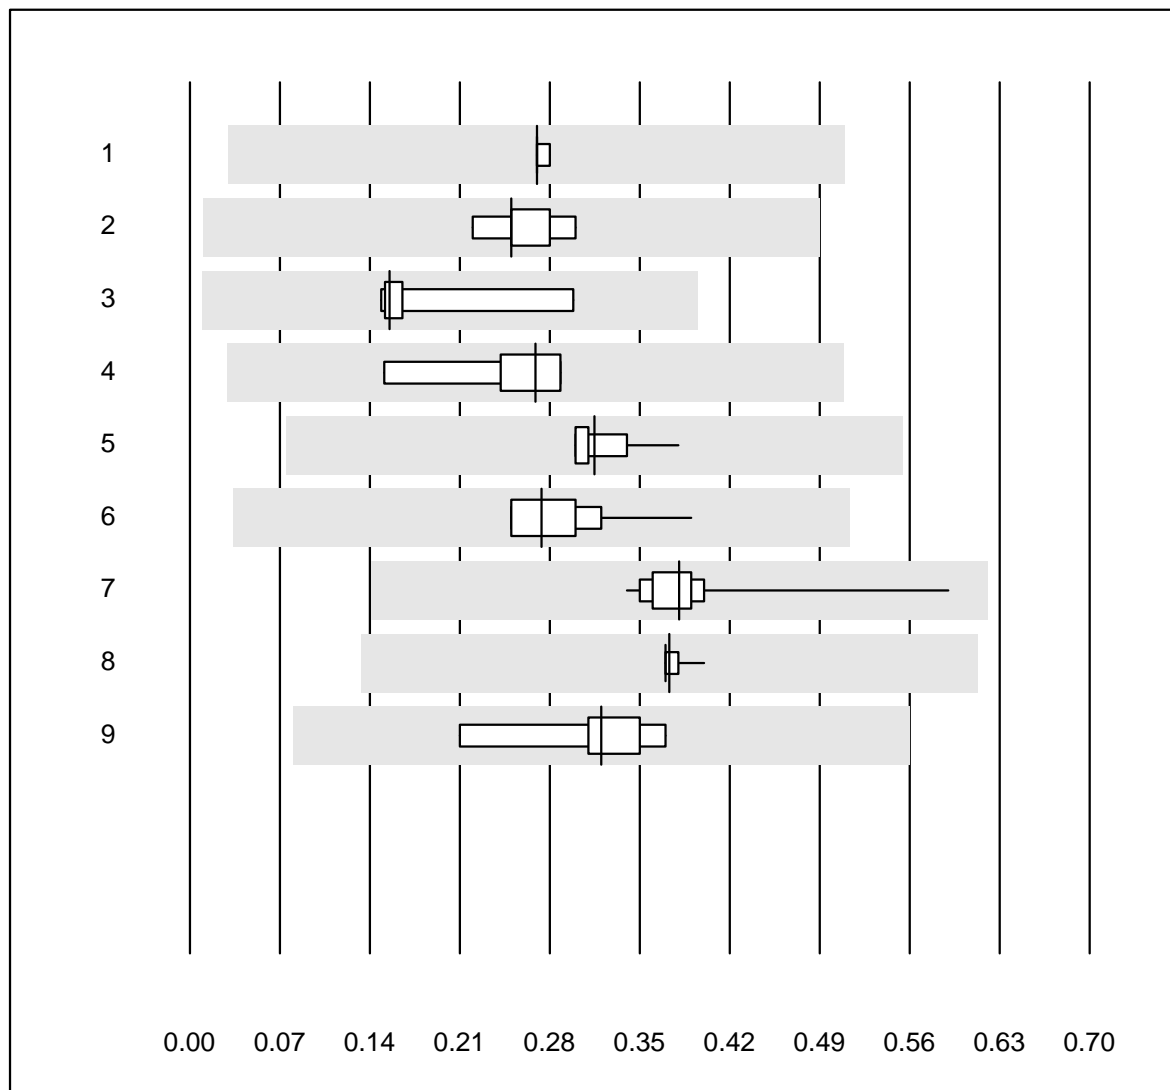


Tolérance MQ : 12 %
(< 2.00: +/- 0.24 mmol/l)

Calcium-BG (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1	GEM	4	100.0	0.0	0.0	0.27	1.8	e
2	ABL80 FLEX	5	100.0	0.0	0.0	0.25	11.9	e*
3	Cobas b123	9	100.0	0.0	0.0	0.16	27.7	e*
4	Cobas	7	100.0	0.0	0.0	0.27	19.2	e*
5	iStat	13	100.0	0.0	0.0	0.31	7.1	e*
6	EPOC	35	100.0	0.0	0.0	0.27	12.4	e*
7	ABL700/800	88	100.0	0.0	0.0	0.38	9.7	e
8	ABL90 FLEX / PLUS	79	100.0	0.0	0.0	0.37	1.5	e
9	ABL80 FLEX CO-OX / O	7	100.0	0.0	0.0	0.32	16.1	e*

FHHb

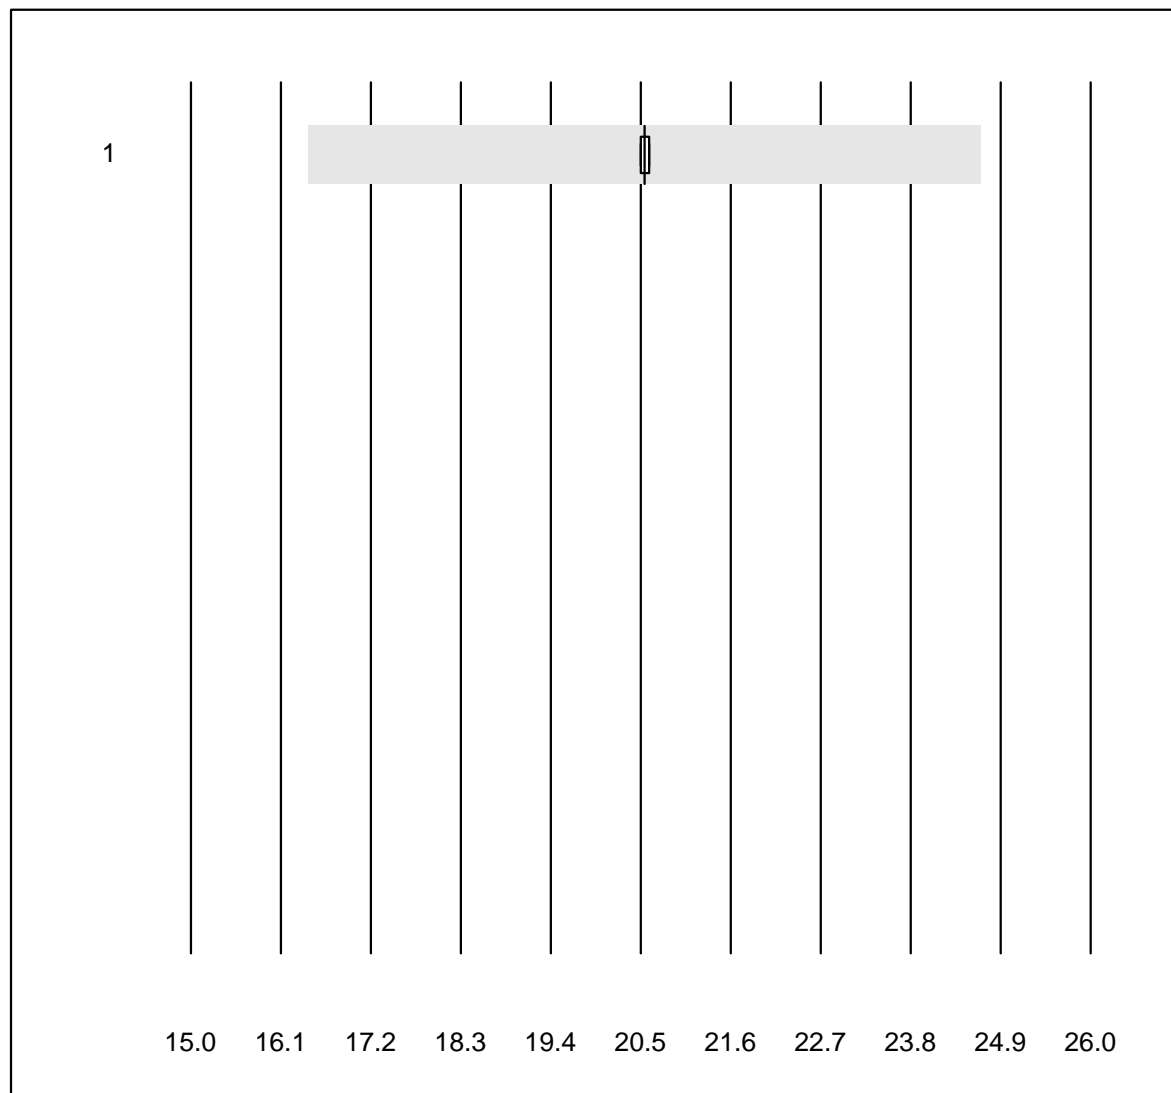


Tolérance MQ : 20 %

FHHb (%)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1	ABL80 FLEX CO-OX / O	6	100.0	0.0	0.0	20.550	0.3	e

Lactate-BG

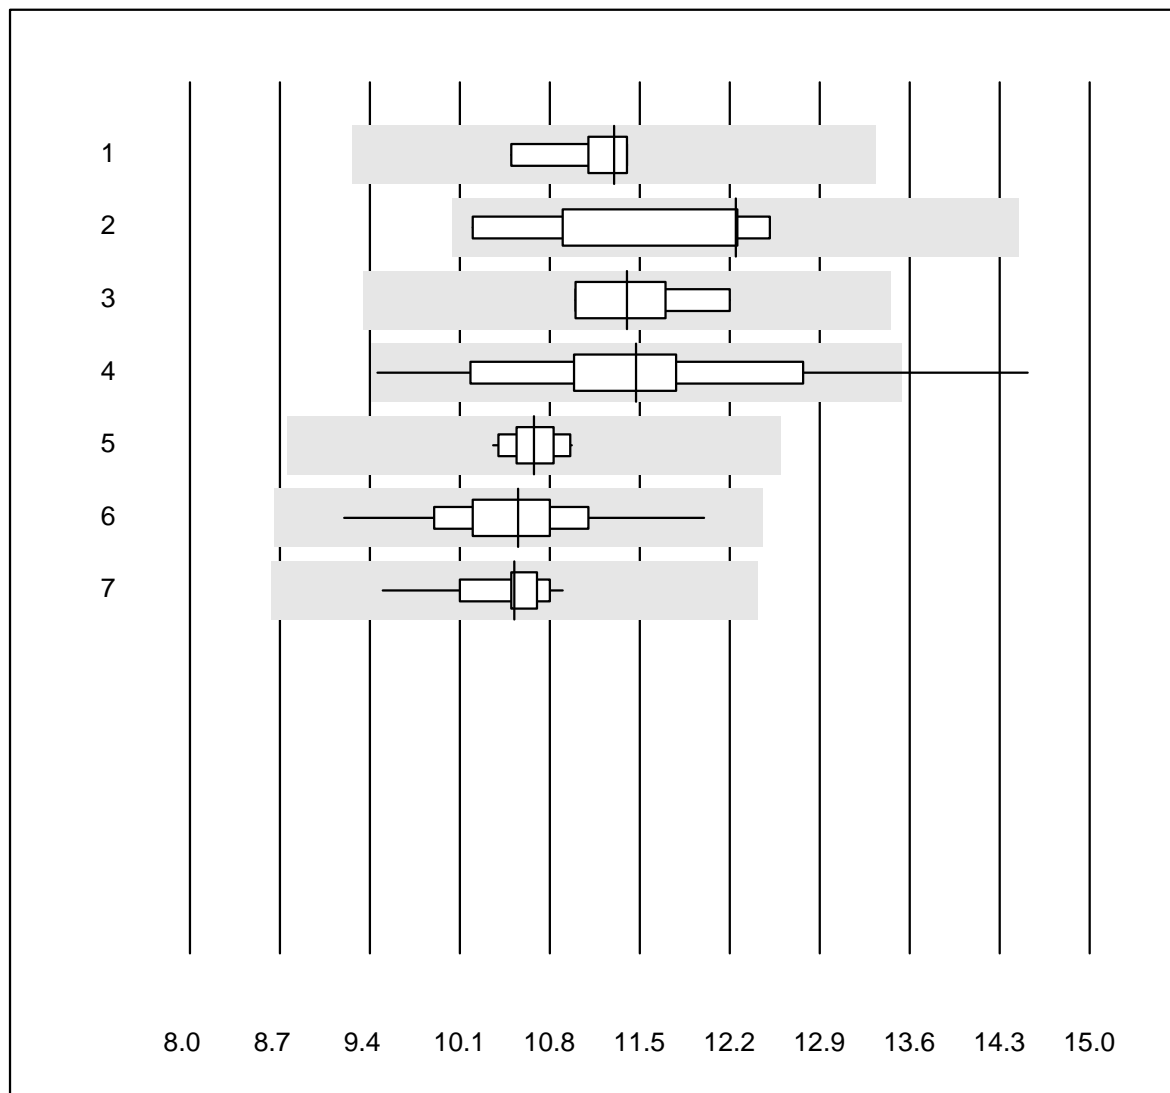


QUALAB Tolérance : 18 %

Lactate-BG (mmol/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas b123	5	100.0	0.0	0.0	11.30	3.4	e
2 Cobas	6	83.3	0.0	16.7	12.25	8.7	e*
3 IL	4	100.0	0.0	0.0	11.40	4.9	e*
4 EPOC	38	92.1	2.6	5.3	11.47	8.6	e
5 iStat	14	100.0	0.0	0.0	10.67	1.8	e
6 ABL700/800	92	100.0	0.0	0.0	10.56	4.6	e
7 ABL90 FLEX / PLUS	81	100.0	0.0	0.0	10.52	2.9	e

sO2 OR

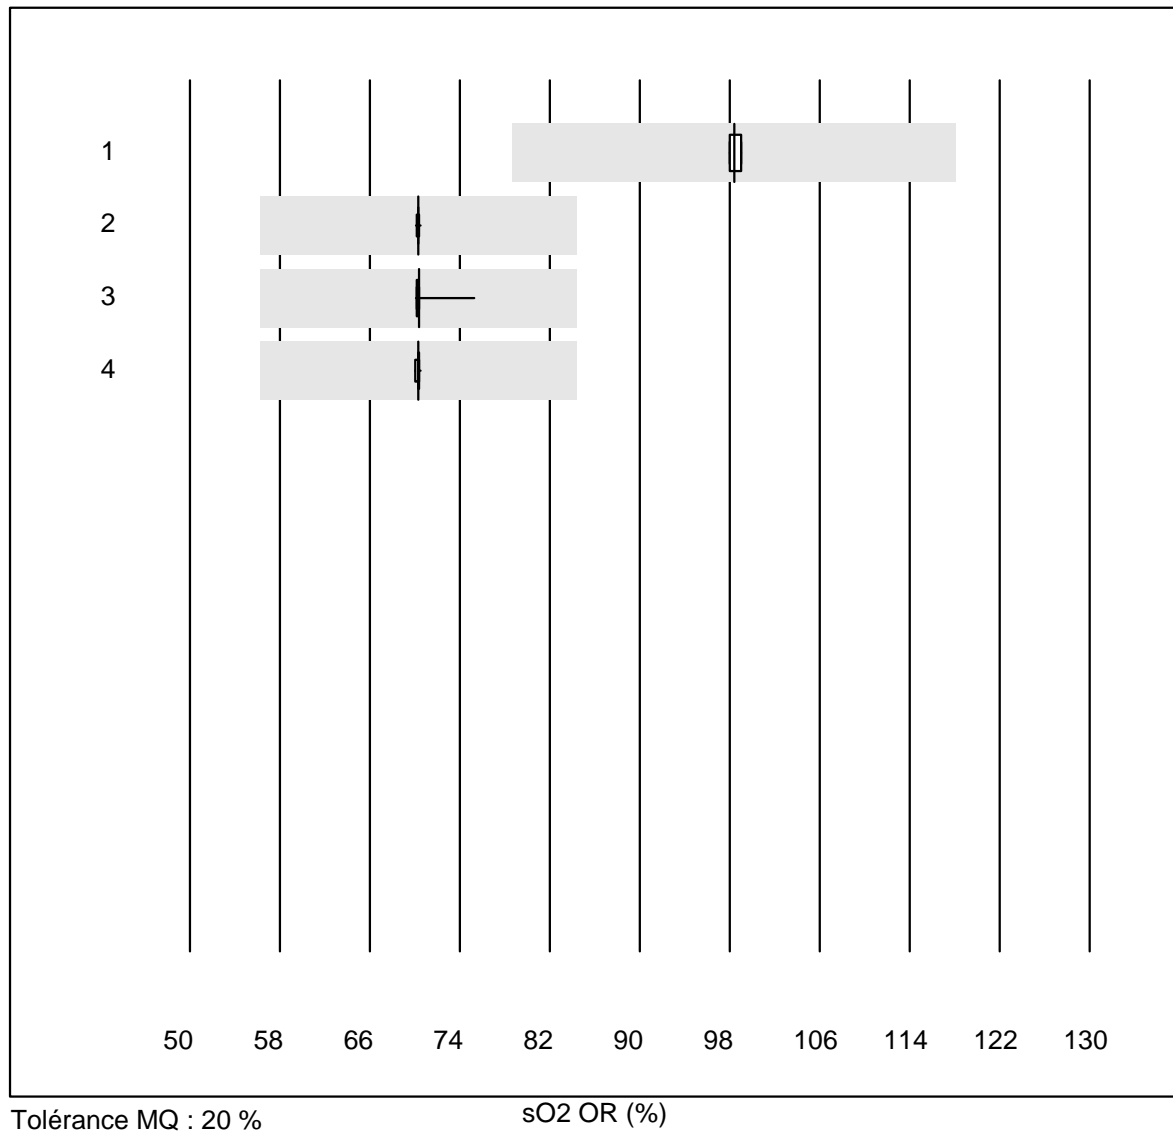

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 iStat	12	100.0	0.0	0.0	98.417	0.5	e
2 ABL700/800	76	100.0	0.0	0.0	70.303	0.1	e
3 ABL90 FLEX / PLUS	71	100.0	0.0	0.0	70.347	0.9	e
4 ABL80 FLEX CO-OX / O	11	90.9	0.0	9.1	70.320	0.2	e

FO2Hb OR

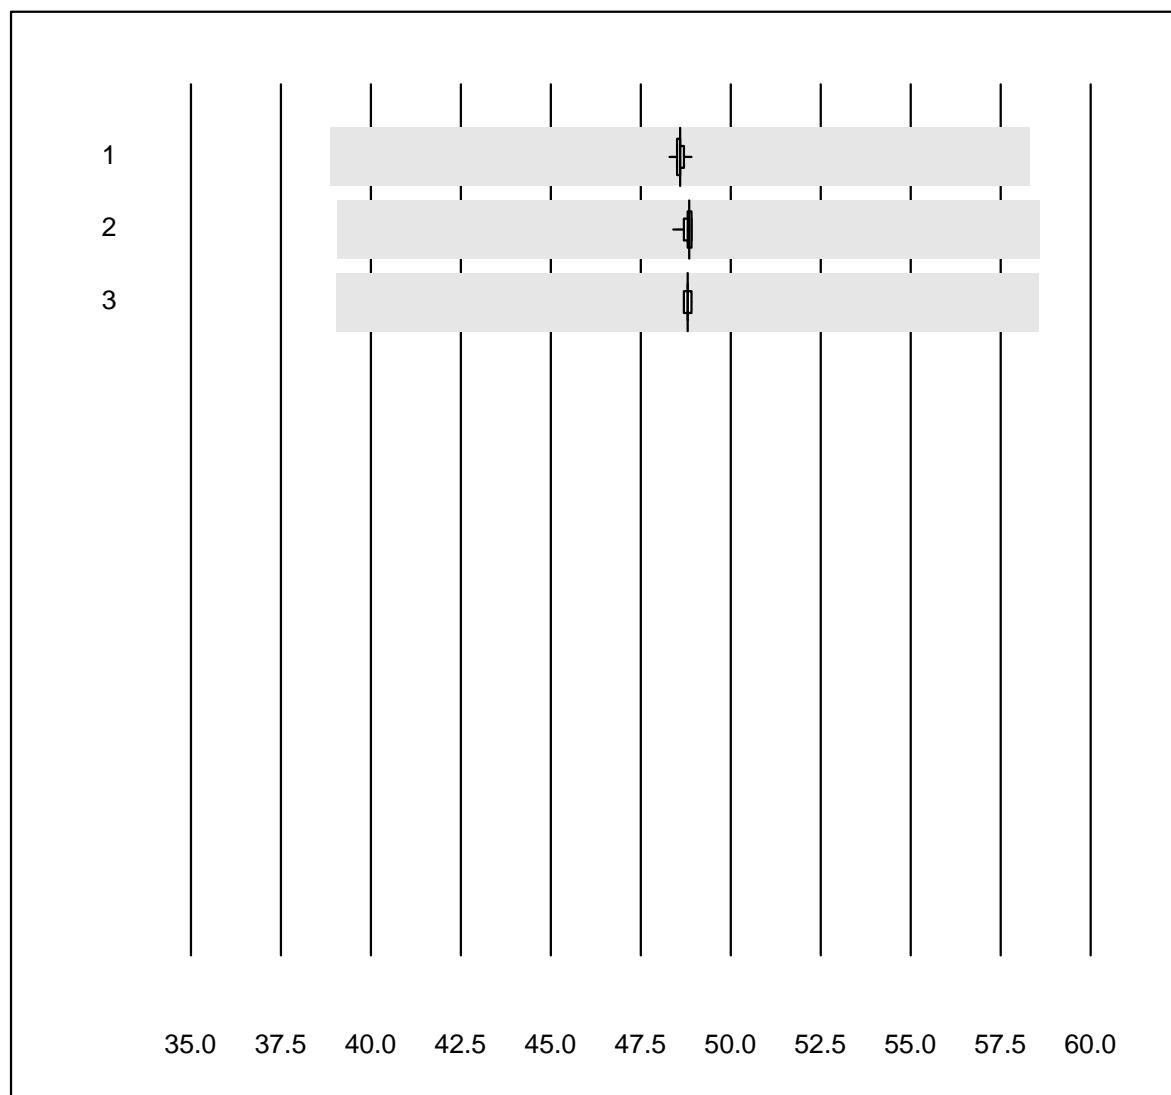


Tolérance MQ : 20 %

FO2Hb OR (%)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 ABL700/800	75	100.0	0.0	0.0	48.585	0.2	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	71	98.6	0.0	1.4	48.836	0.2	e
3 ABL80 FLEX CO-OX / O	12	100.0	0.0	0.0	48.800	0.1	e

FCOHb OR

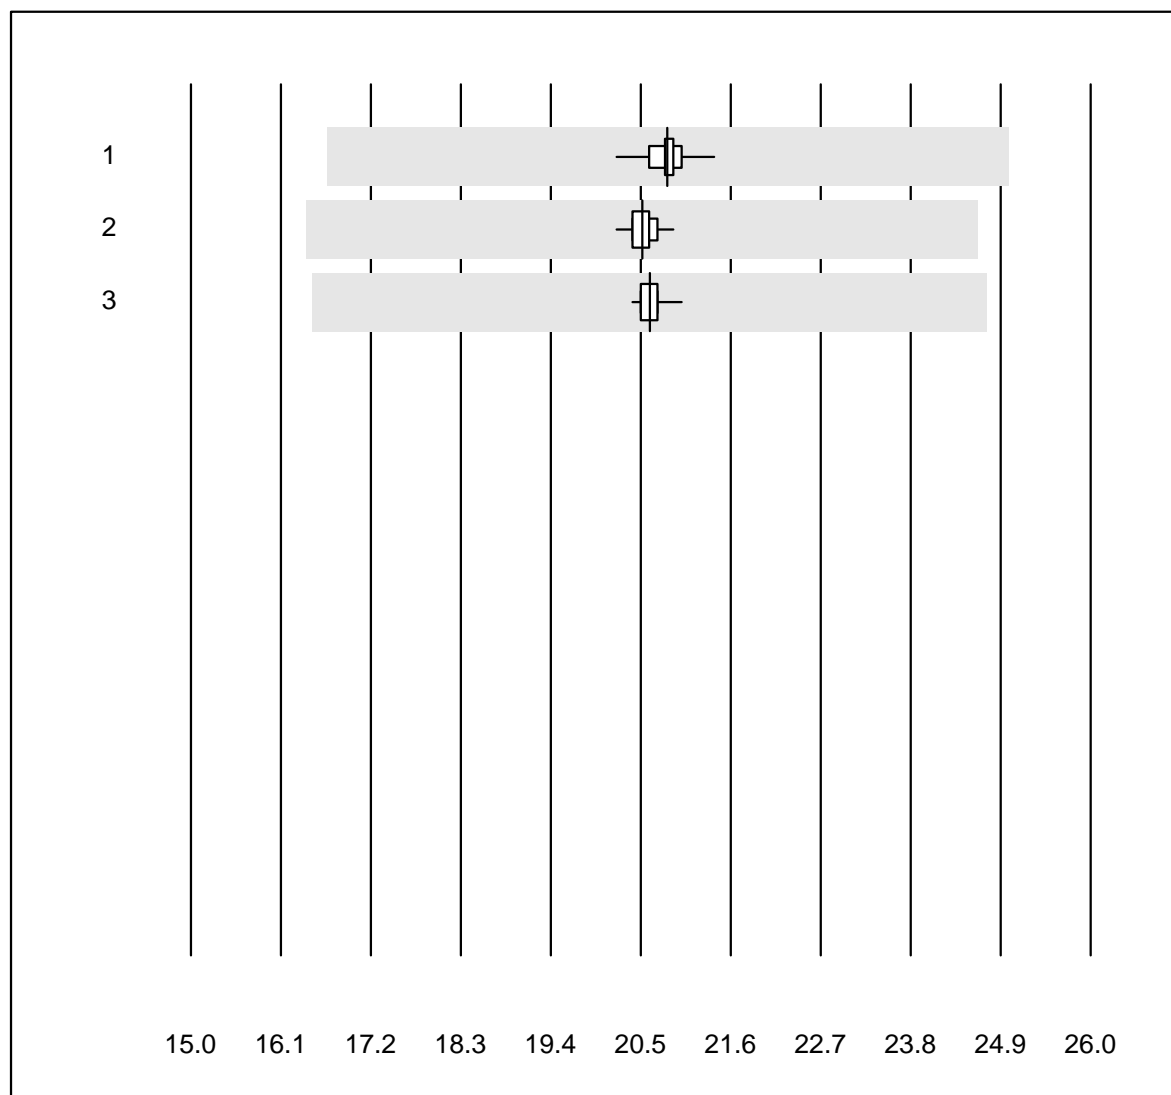


Tolérance MQ : 20 %

FCOHb OR (%)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 ABL700/800	77	100.0	0.0	0.0	20.827	0.9	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	70	98.6	0.0	1.4	20.516	0.6	e
3 ABL80 FLEX CO-OX / O	12	100.0	0.0	0.0	20.608	0.8	e

FMetHb OR

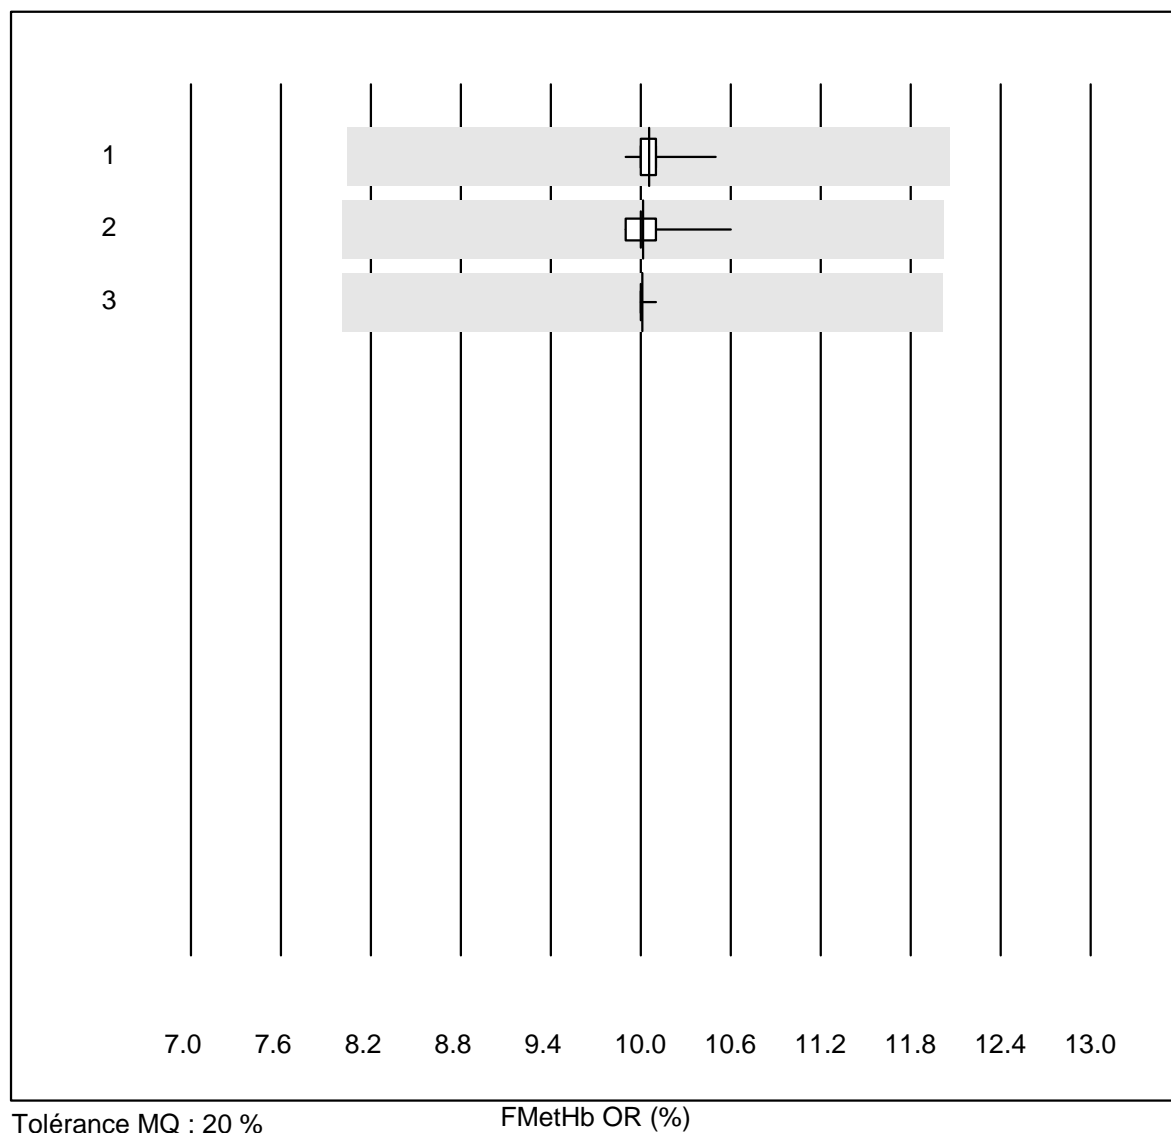


Tolérance MQ : 20 %

FMetHb OR (%)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 ABL700/800	77	100.0	0.0	0.0	10.053	0.9	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	70	97.1	0.0	2.9	10.013	1.2	e
3 ABL80 FLEX CO-OX / O	12	100.0	0.0	0.0	10.008	0.3	e

FHbF OR

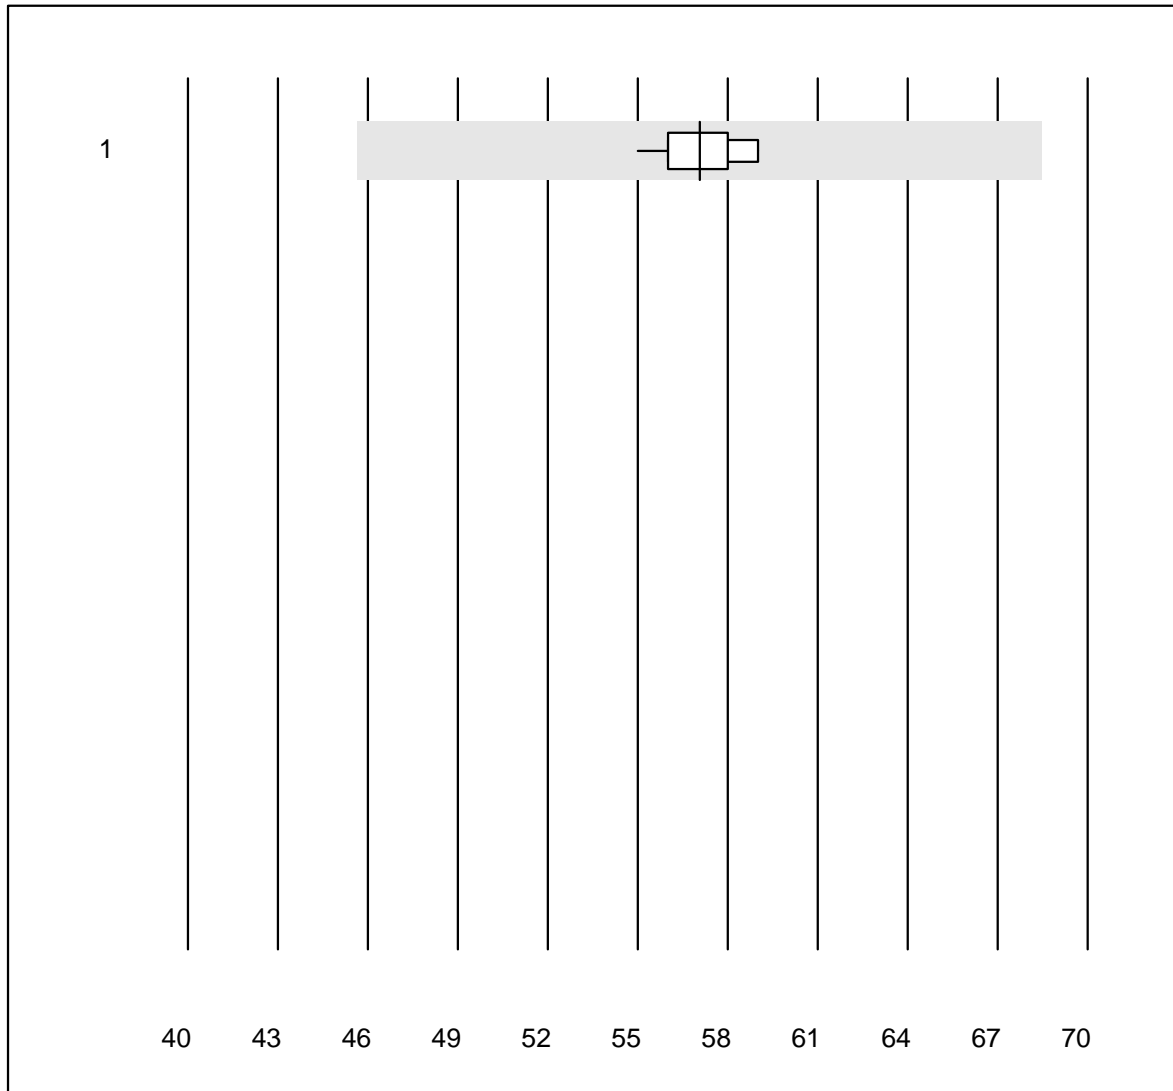


Tolérance MQ : 20 %

FHbF OR (%)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 ABL90 FLEX / PLUS	19	94.7	0.0	5.3	57.056	1.9	e

Bilirubin OR

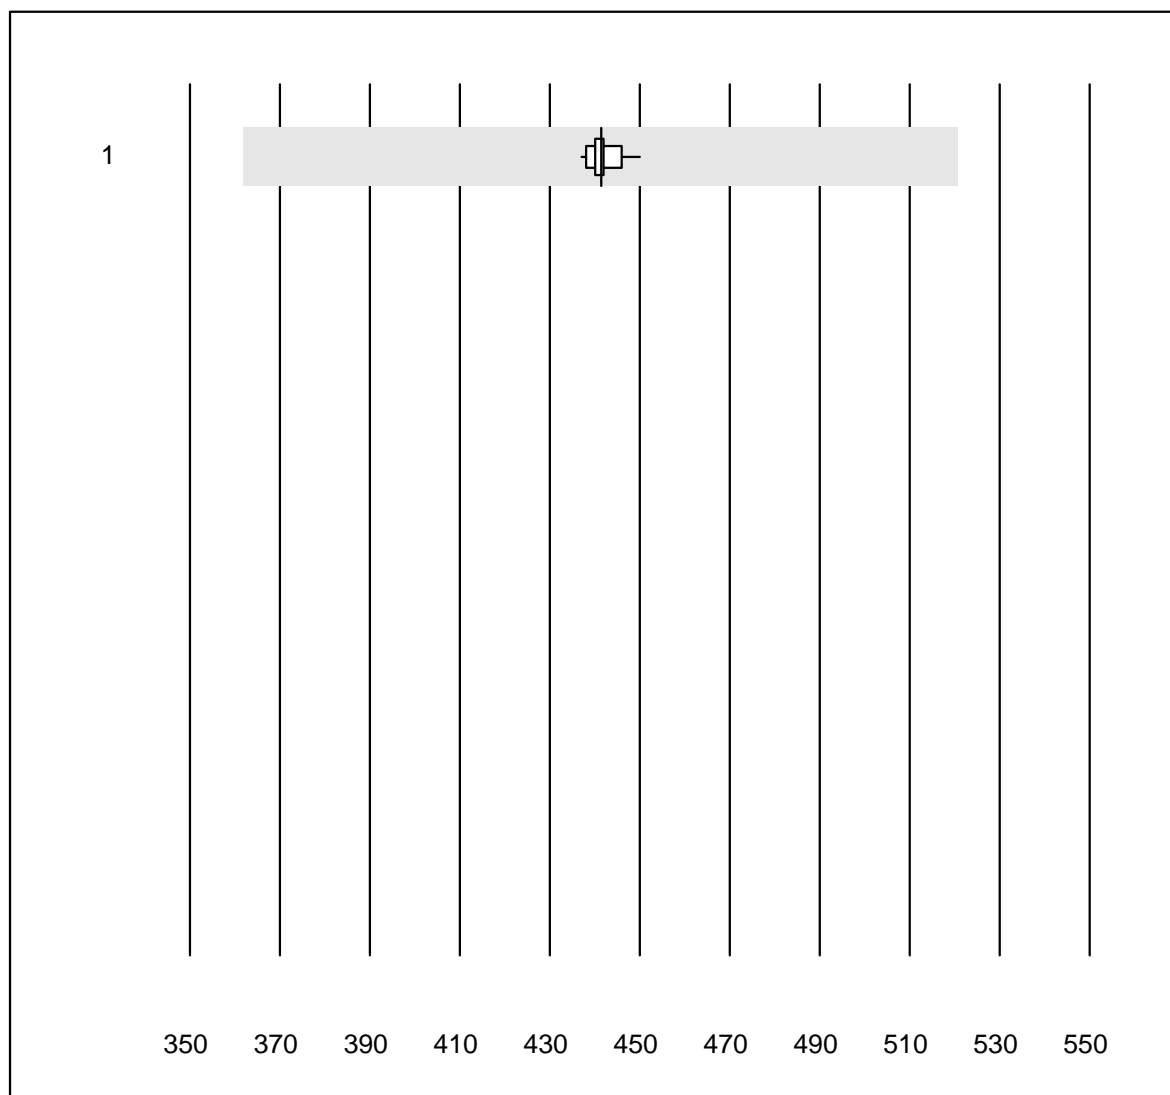


QUALAB Tolérance : 18 %

Bilirubin OR (µmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 ABL90 FLEX / PLUS	25	100.0	0.0	0.0	441.4	0.7	e

Troponine I

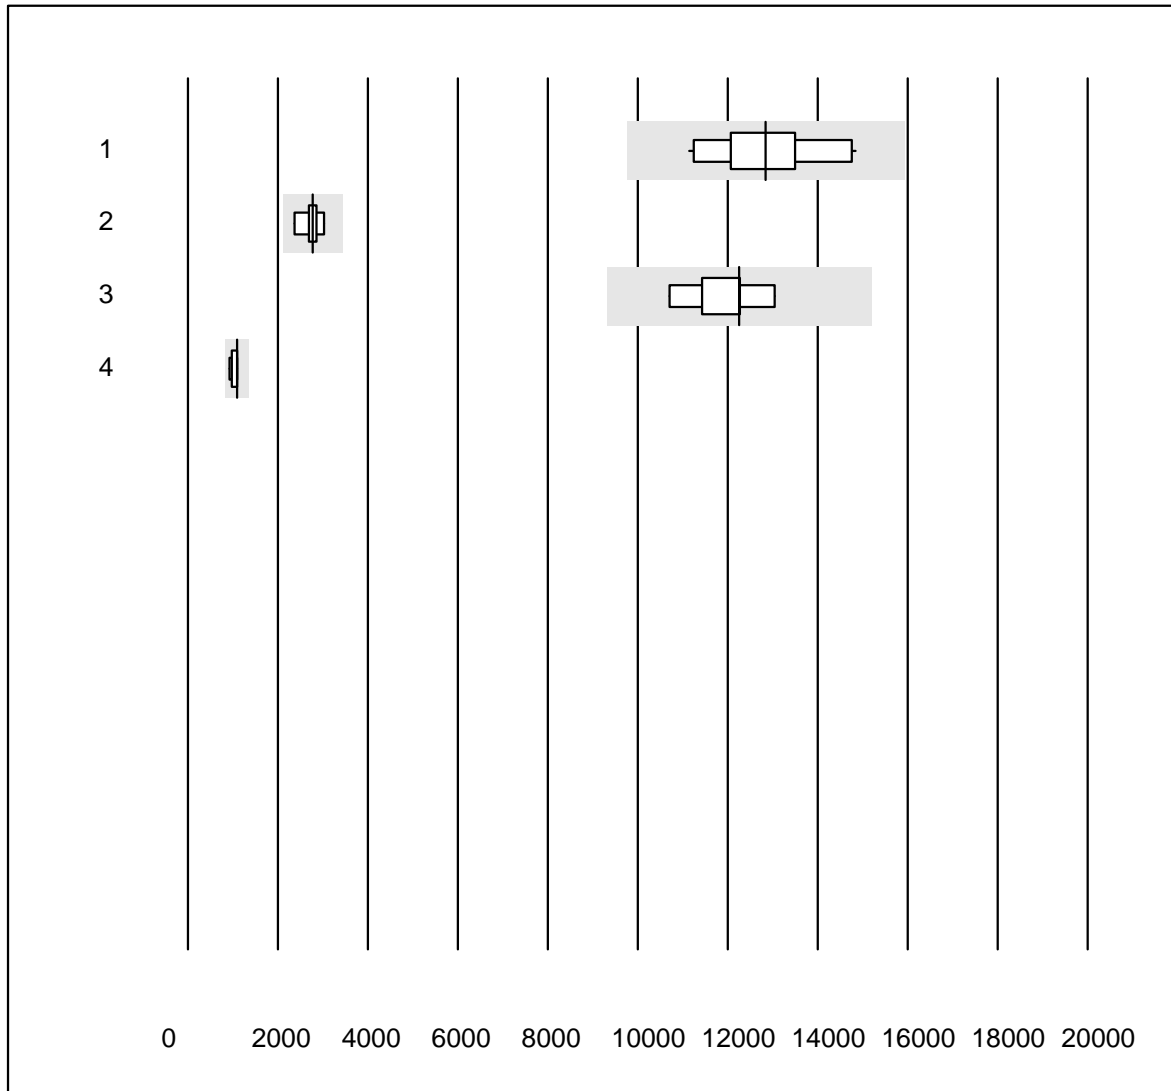


QUALAB Tolérance : 24 %

Troponine I (ng/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Vidas	13	100.0	0.0	0.0	12844.2	9.1	e
2 Architect High Sensi	9	100.0	0.0	0.0	2779.1	7.0	e
3 Autres méthodes	7	100.0	0.0	0.0	12248.0	6.2	e
4 AQT 90 FLEX	5	100.0	0.0	0.0	1100.0	8.0	e*

Troponine T

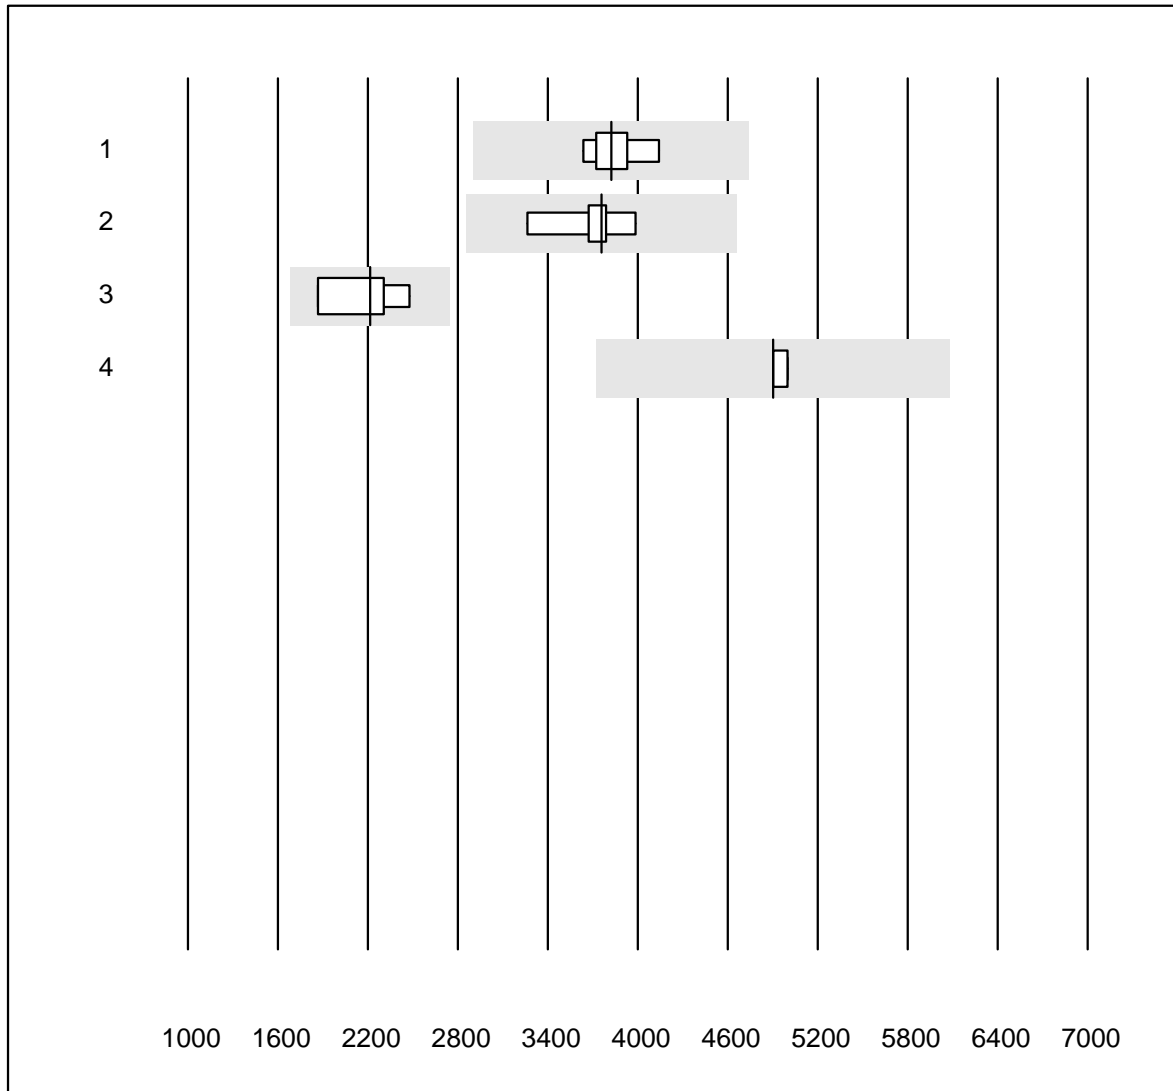


QUALAB Tolérance : 24 %

Troponine T (ng/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas hs	5	100.0	0.0	0.0	3822.00	5.1	e
2 Cobas hs STAT	8	100.0	0.0	0.0	3757.50	5.8	e
3 Cobas E / Elecsys	4	100.0	0.0	0.0	2213.00	11.9	e*
4 AQT 90 FLEX	4	75.0	0.0	25.0	4900.00	1.2	e

Myoglobine

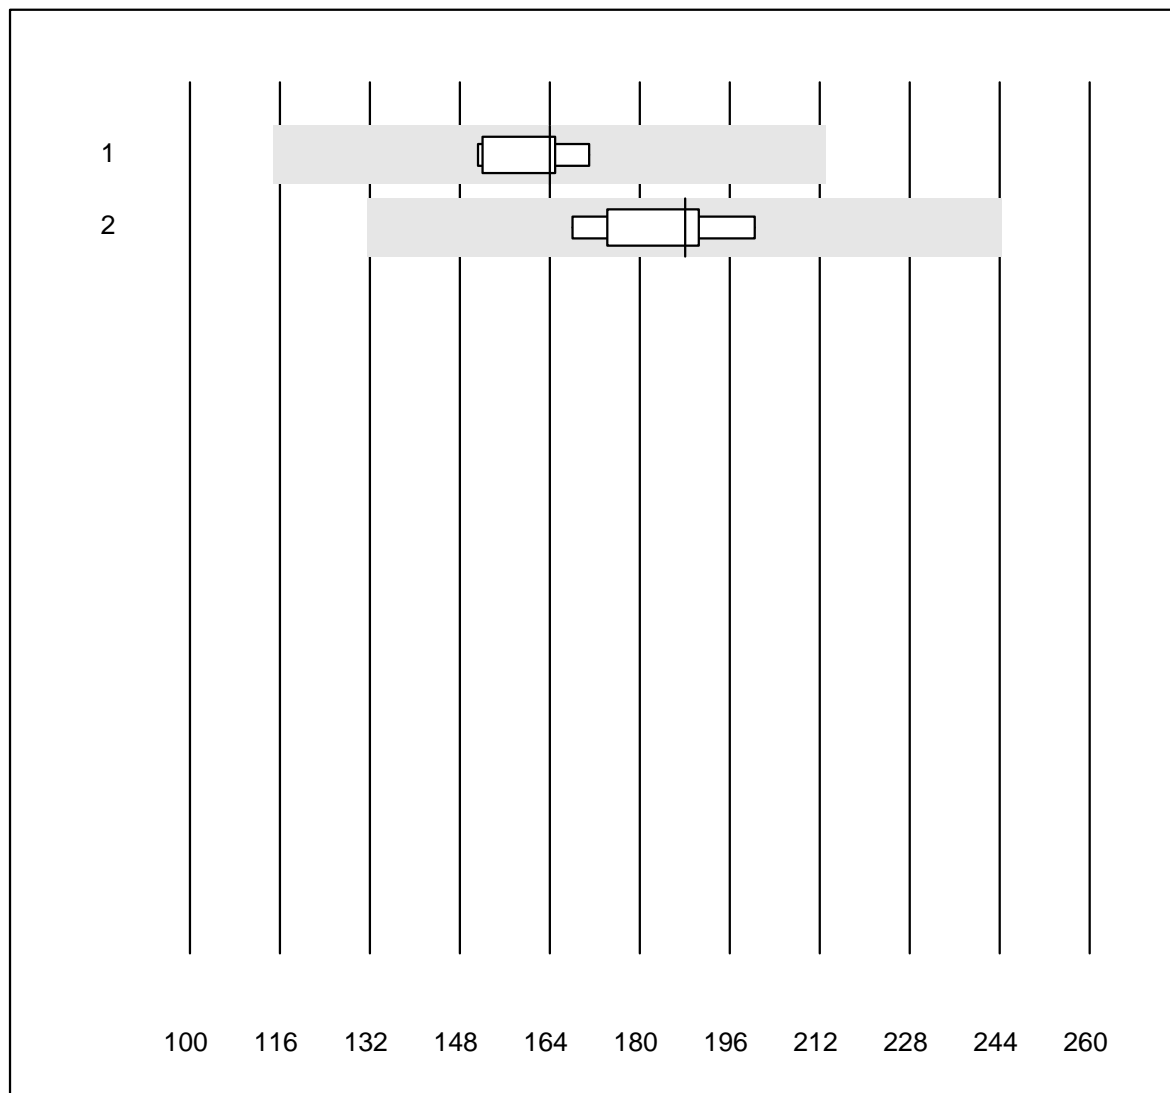


QUALAB Tolérance : 30 %

Myoglobine (µg/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas E / Elecsys	6	100.0	0.0	0.0	164.0	4.9	e
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	188.0	7.1	e

masse CK-MB

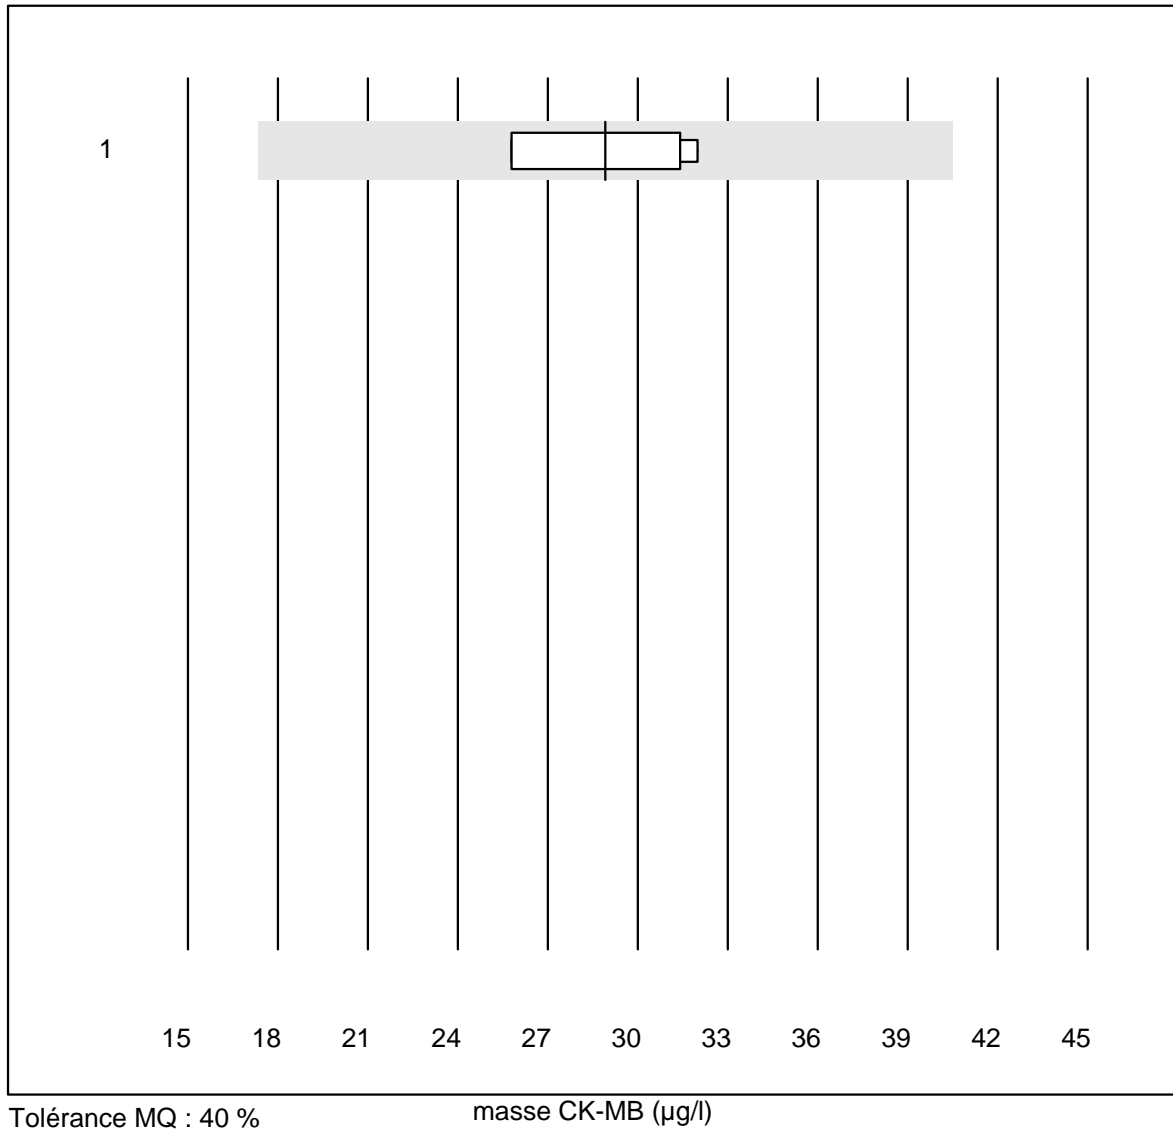


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas E / Elecsys	4	100.0	0.0	0.0	28.9	11.2	e*

NT-proBNP

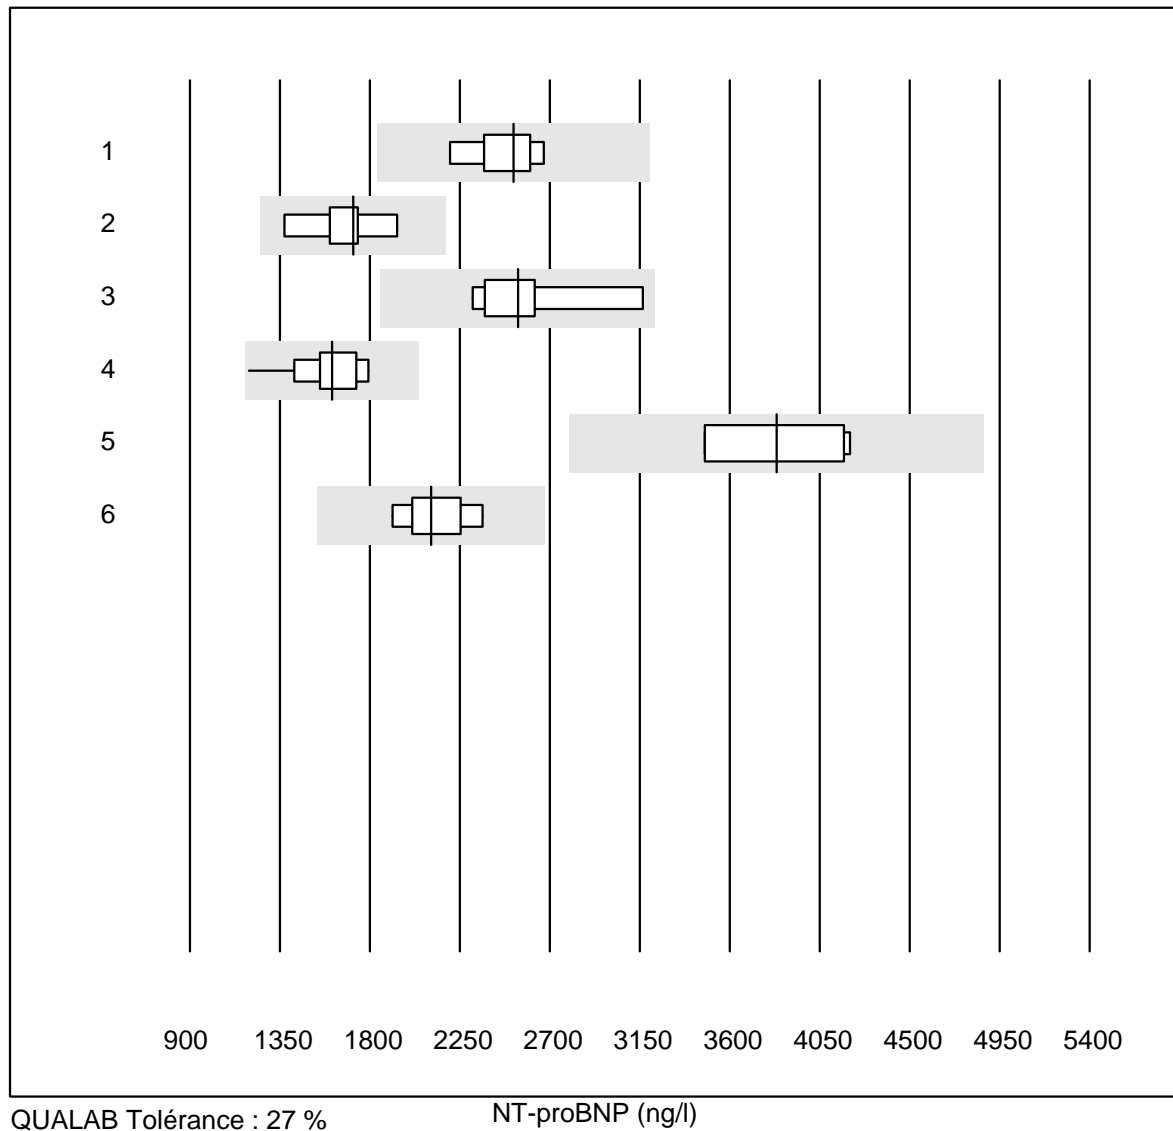

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 AQT 90 FLEX	7	100.0	0.0	0.0	2520.0	6.5	e
2 VIDAS	9	100.0	0.0	0.0	1717.0	9.3	e
3 Autres méthodes	6	83.3	0.0	16.7	2540.5	13.2	e*
4 Cobas E / Elecsys	16	100.0	0.0	0.0	1610.8	9.8	e
5 Immulite	4	100.0	0.0	0.0	3834.0	10.5	e*
6 Architect	7	100.0	0.0	0.0	2105.0	7.1	e

TSH

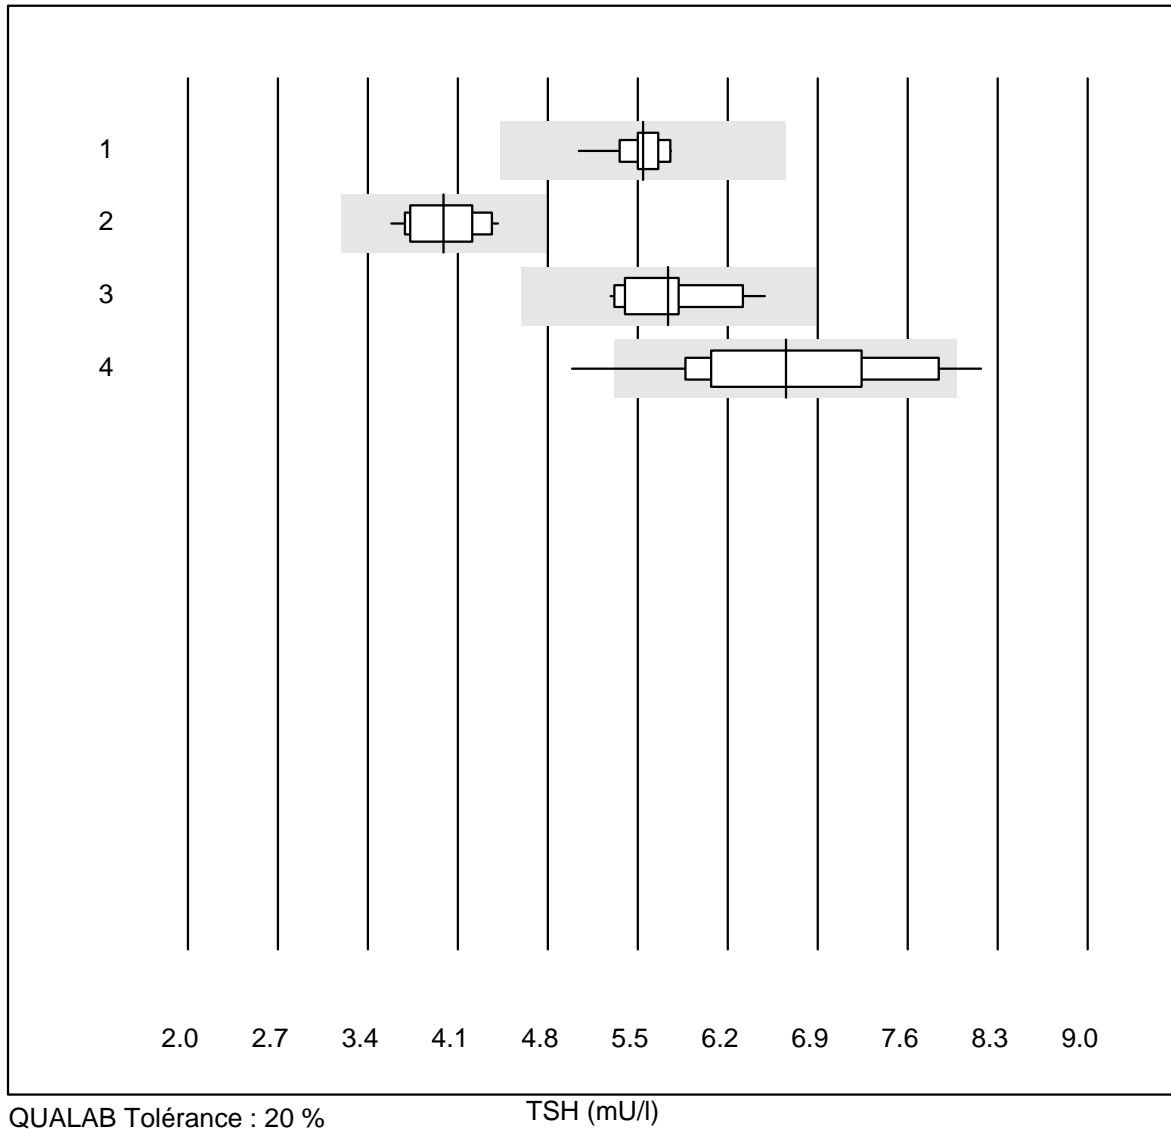


QUALAB Tolérance : 20 %

TSH (mU/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas E / Elecsys	16	100.0	0.0	0.0	5.54	3.3	e
2 Architect	11	100.0	0.0	0.0	3.99	7.0	e
3 VIDAS	16	100.0	0.0	0.0	5.74	6.5	e
4 AFIAS	35	91.4	8.6	0.0	6.65	11.8	e

T3

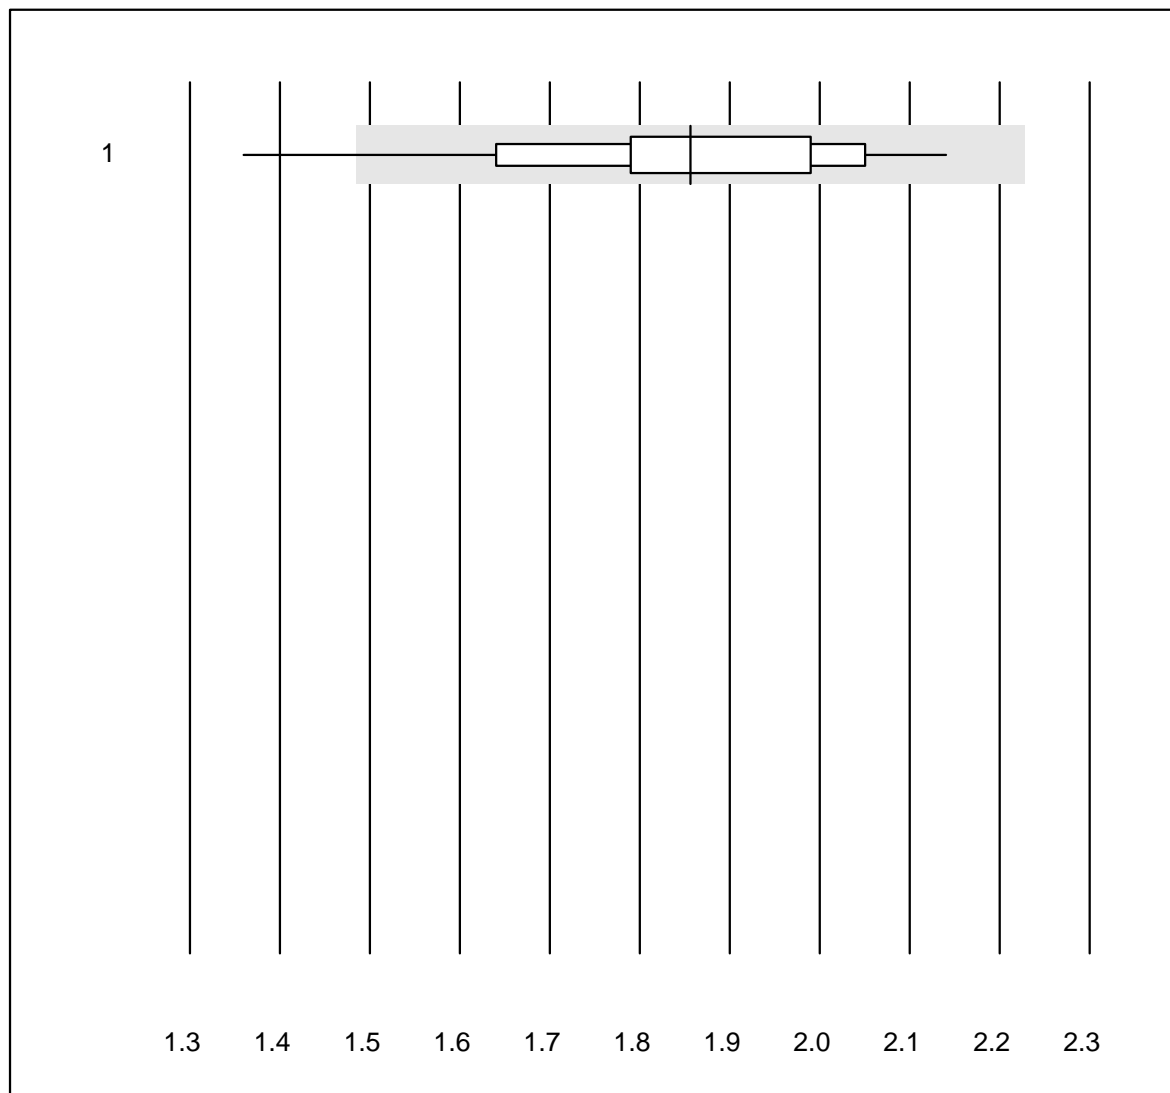


Tolérance MQ : 20 %

T3 (nmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 AFIAS	12	91.7	8.3	0.0	1.9	11.0	e*

T4

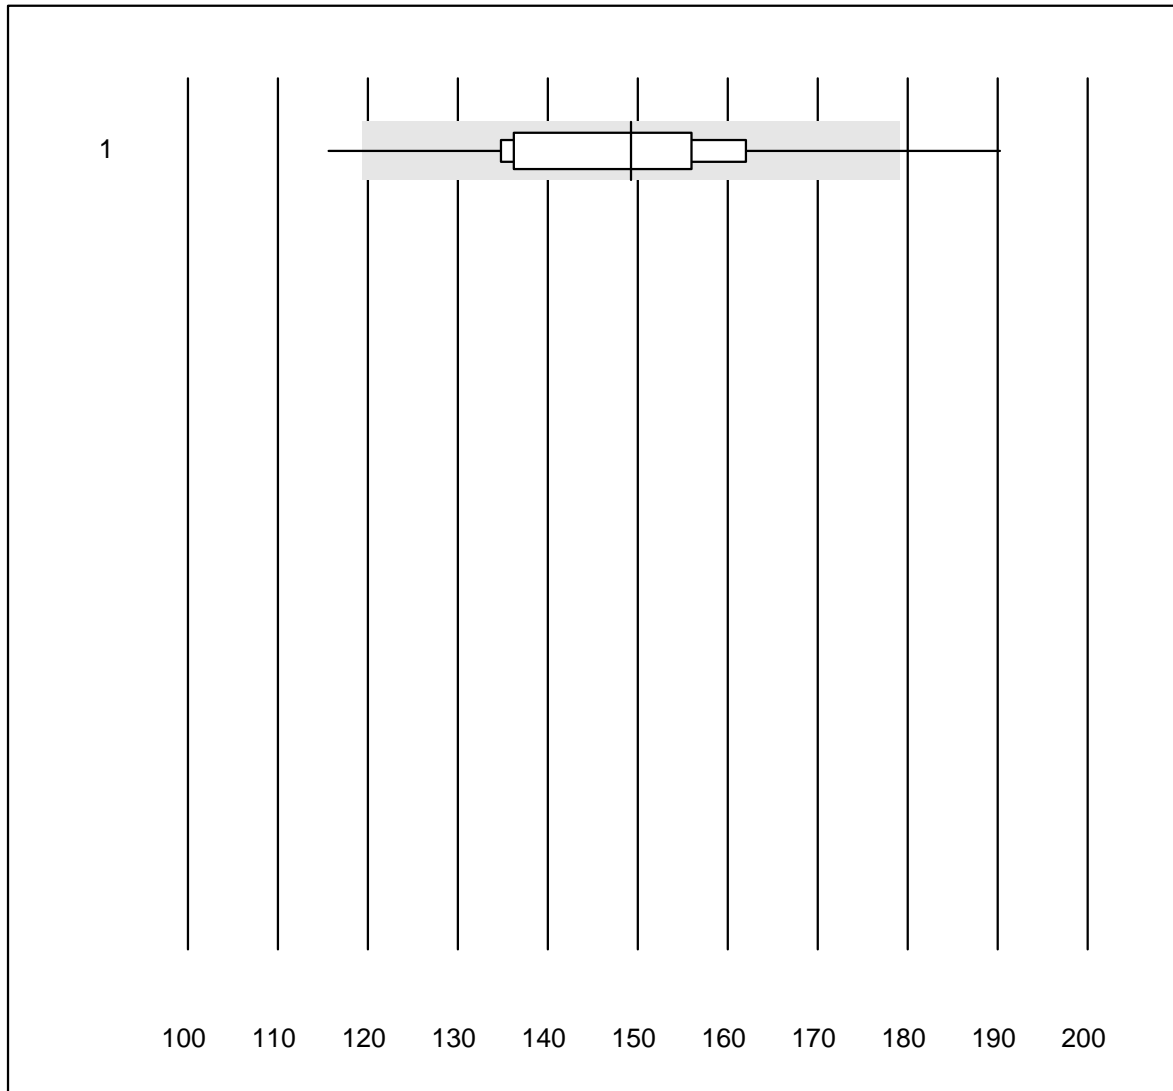


Tolérance MQ : 20 %

T4 (nmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 AFIAS	12	83.3	16.7	0.0	149	12.4	e*


FT3

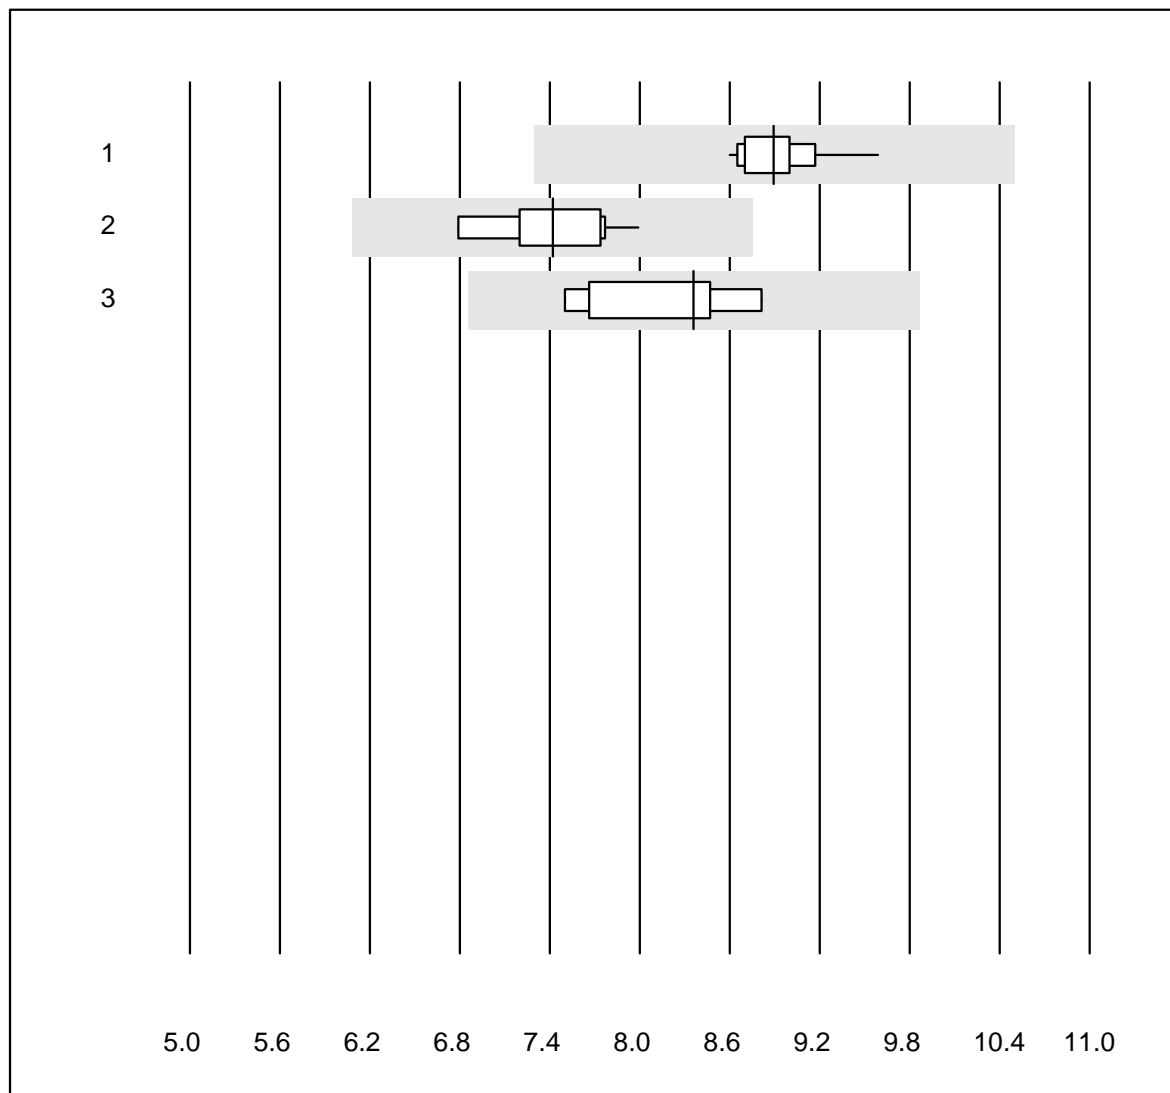

QUALAB Tolérance : 18 %

FT3 (pmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas E / Elecsys	14	100.0	0.0	0.0	8.9	2.9	e
2 Architect	10	100.0	0.0	0.0	7.4	5.0	e
3 VIDAS	7	100.0	0.0	0.0	8.4	5.7	e

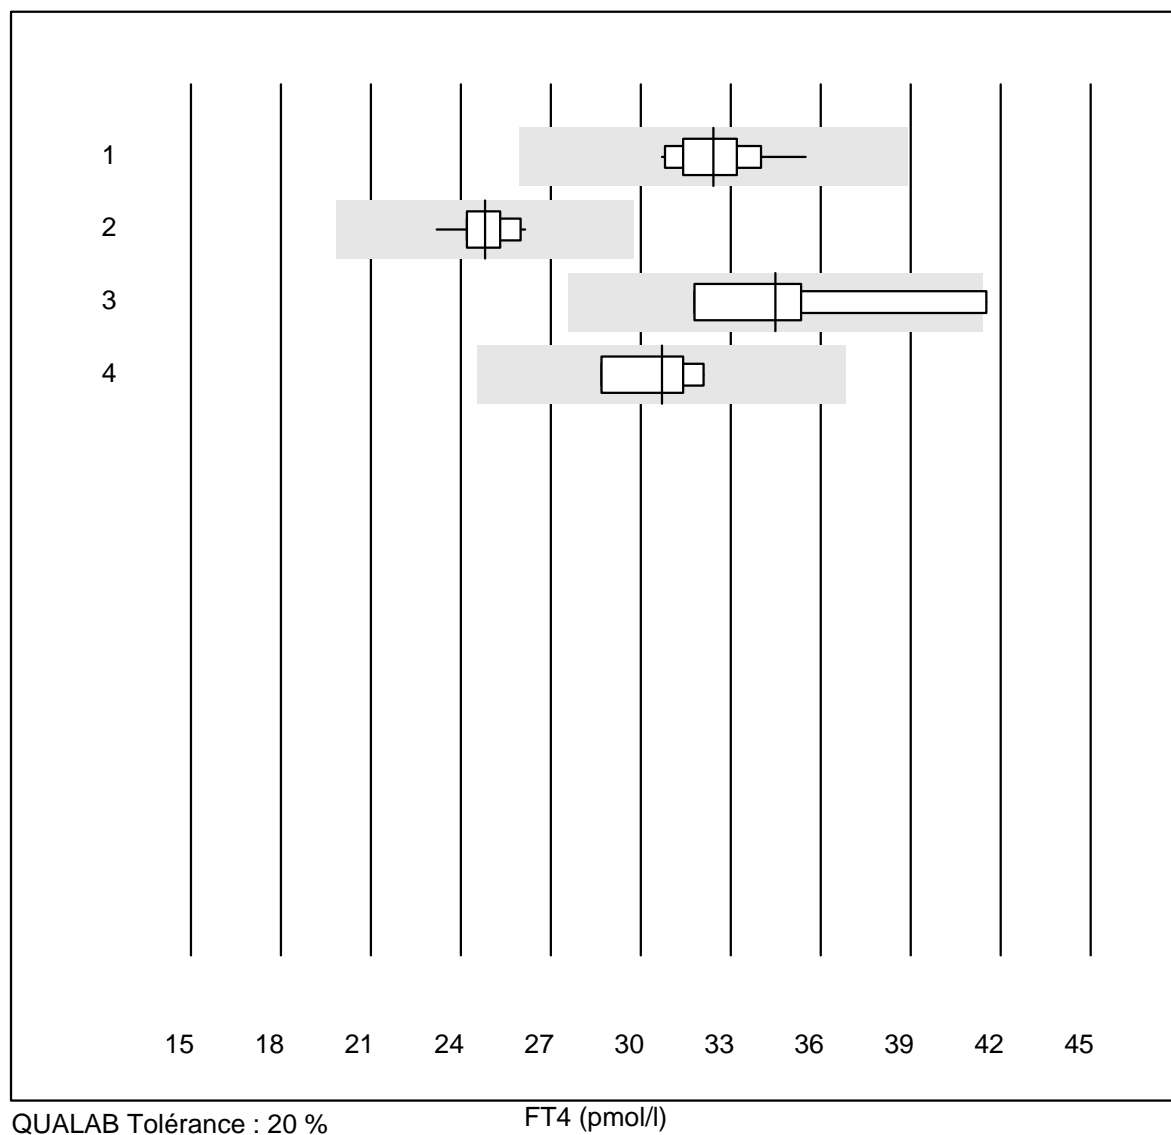
FT4

QUALAB Tolérance : 20 %

FT4 (pmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas E / Elecsys	15	100.0	0.0	0.0	32.4	4.0	e
2 Architect	11	100.0	0.0	0.0	24.8	3.4	e
3 VIDAS	8	87.5	12.5	0.0	34.5	9.9	e*
4 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	30.7	5.0	e*

Testostérone

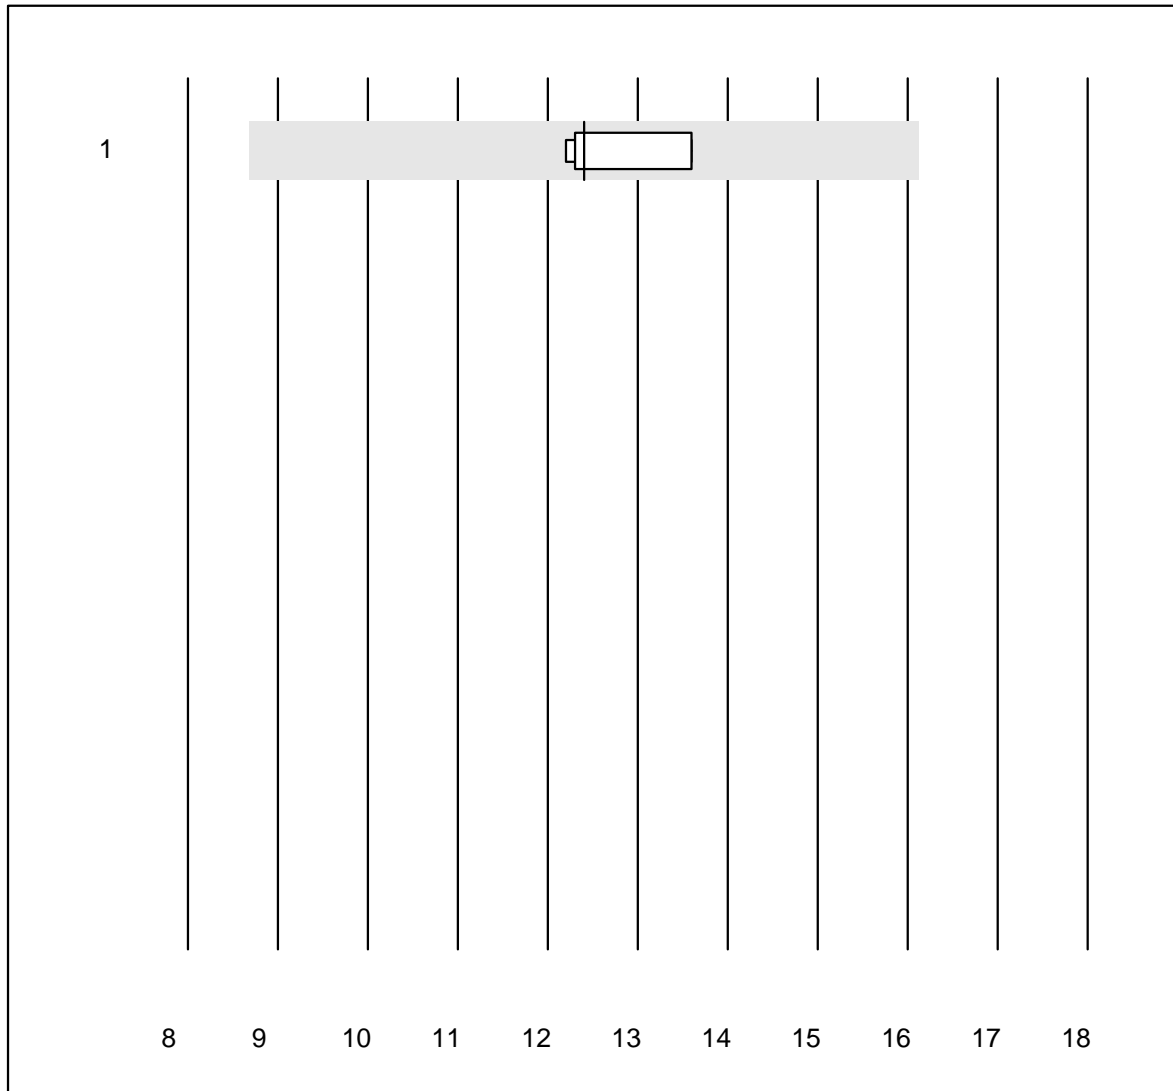


QUALAB Tolérance : 30 %

Testostérone (nmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas	7	100.0	0.0	0.0	12.4	4.7	e

Estradiol

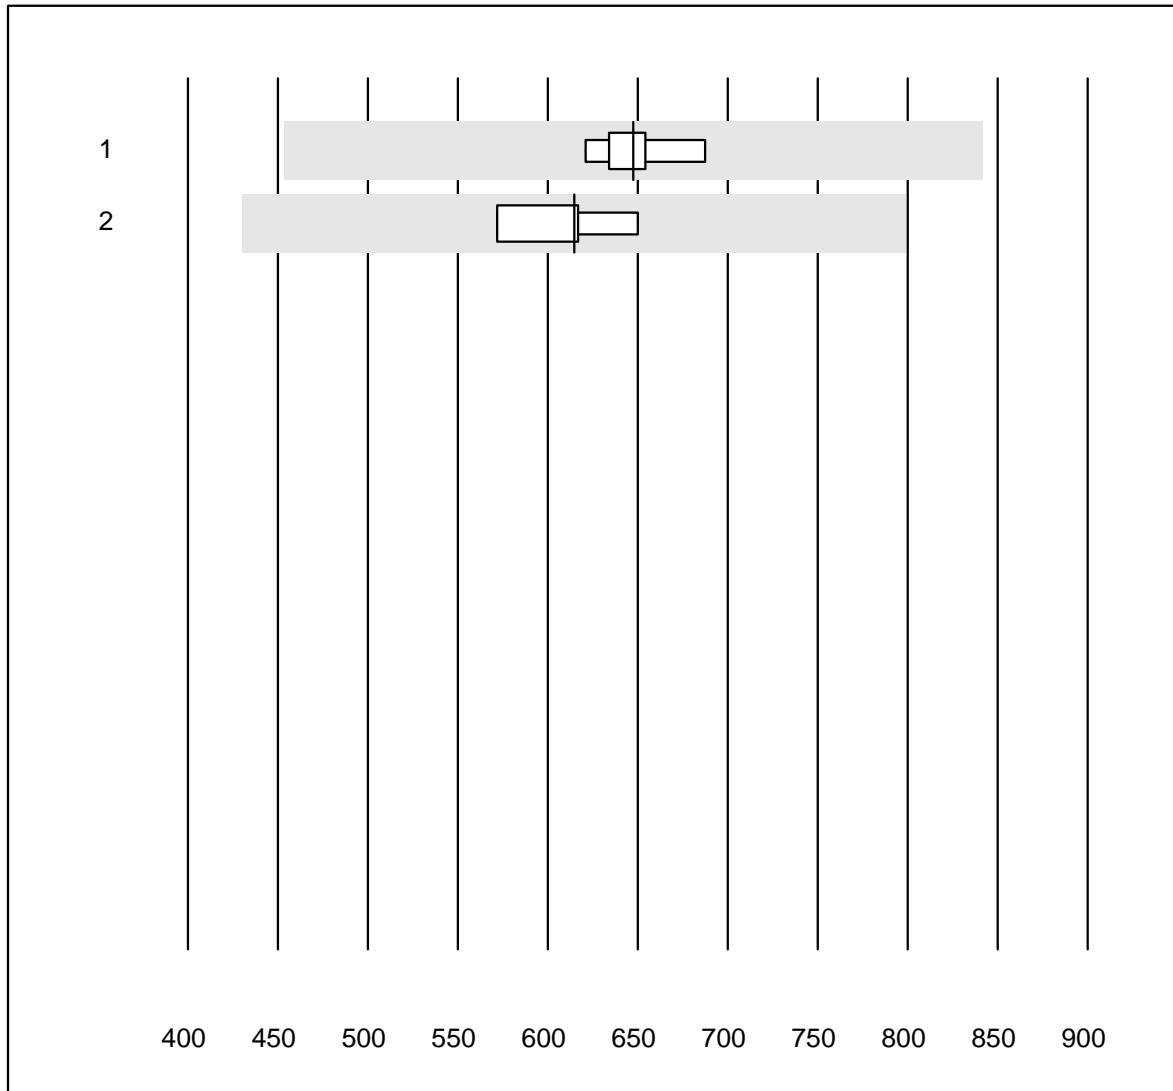


QUALAB Tolérance : 30 %

Estradiol (pmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas	6	100.0	0.0	0.0	648	3.5	e
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	615	5.2	e

SHBG

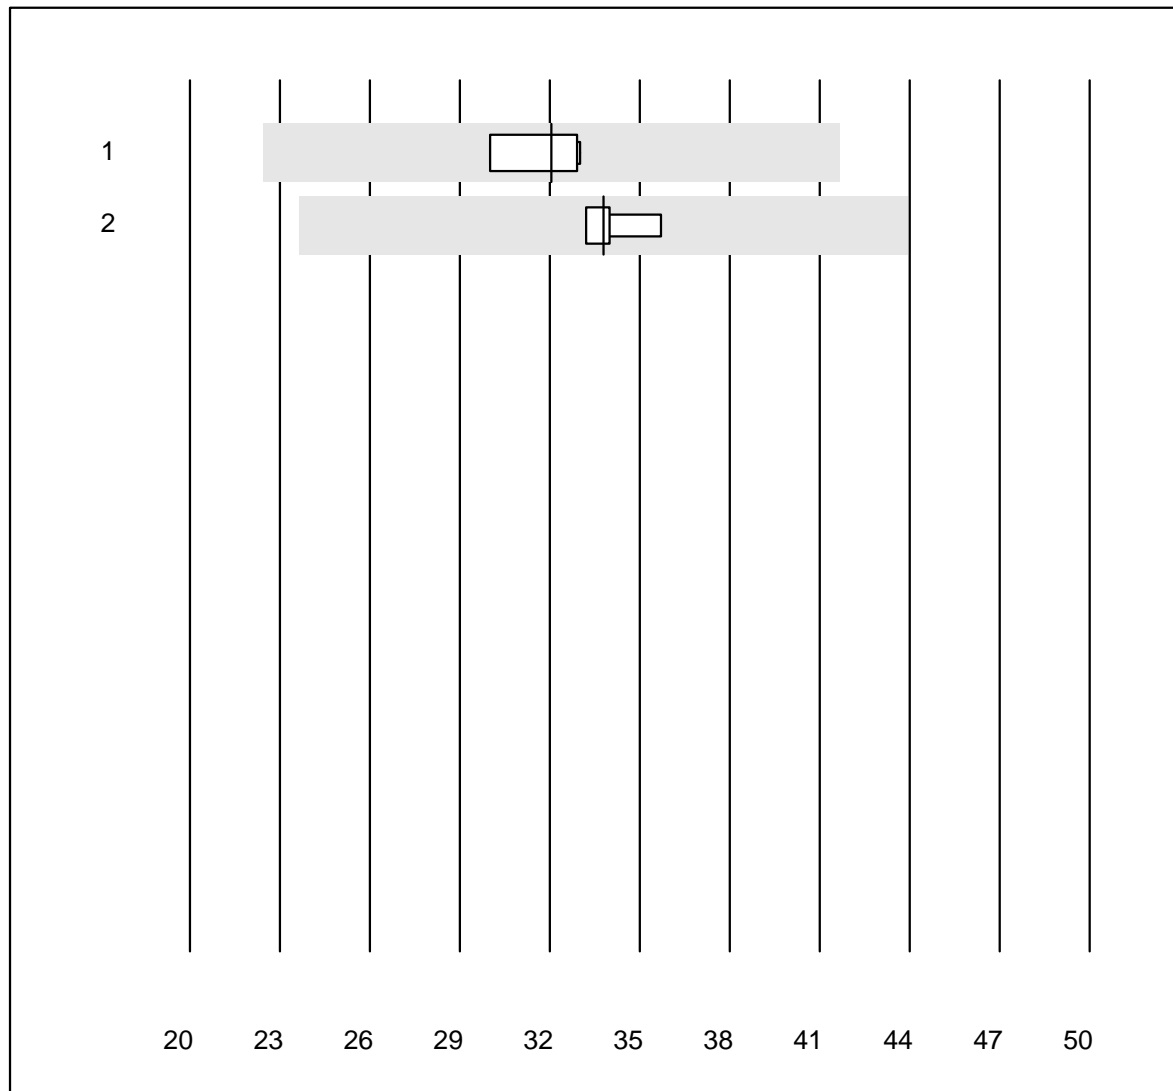


Tolérance MQ : 30 %

SHBG (nmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	32.1	4.5	e
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	33.8	3.2	e

Cortisol

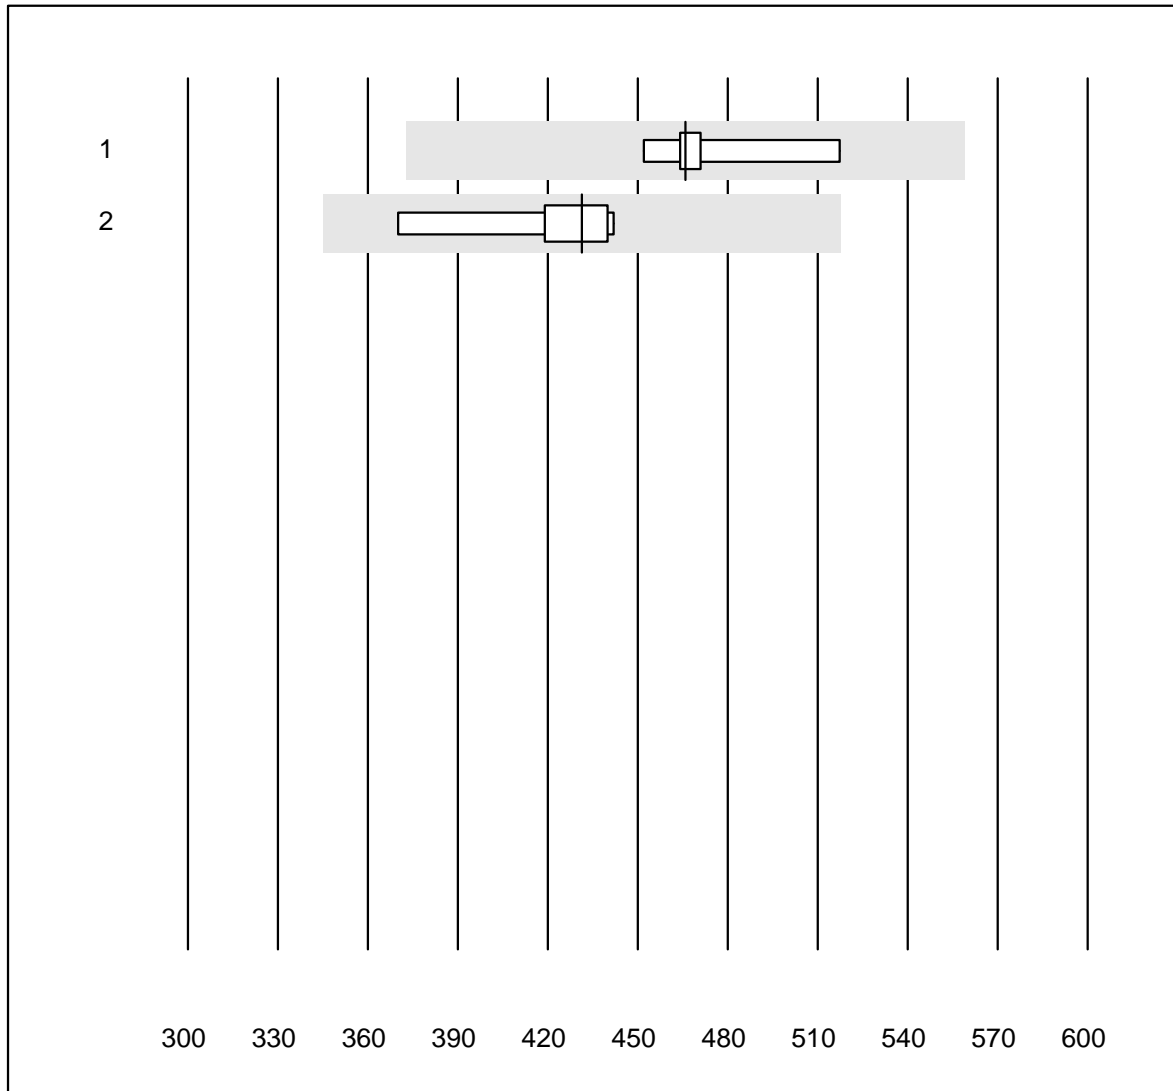


QUALAB Tolérance : 20 %

Cortisol (nmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas E / Elecsys	9	100.0	0.0	0.0	466	4.0	e
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	431	7.0	e*

DHEAS

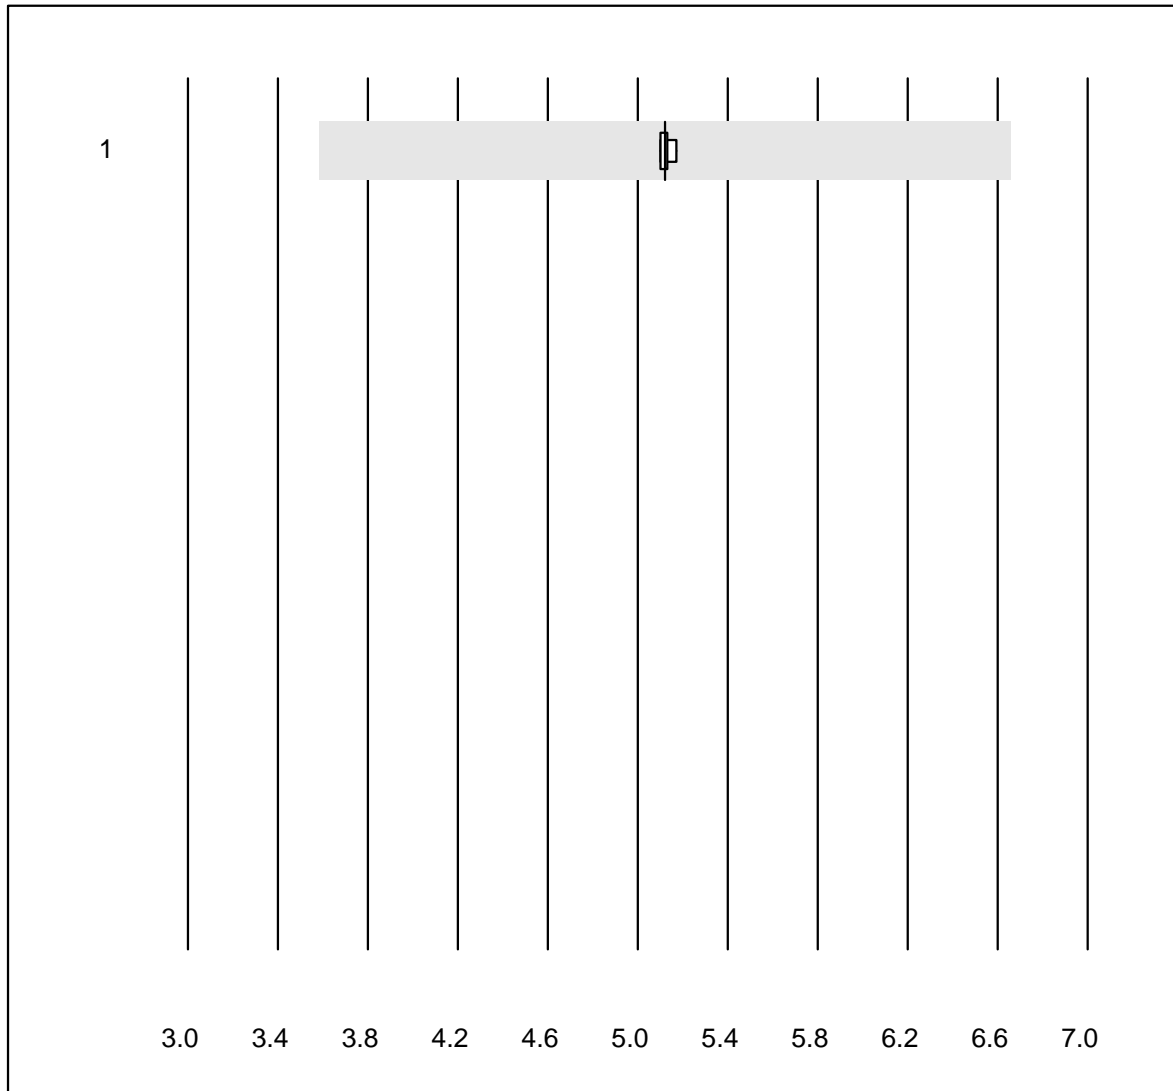


Tolérance MQ : 30 %

DHEAS (µmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	5.12	0.6	e

Luteinisierendes Hormon

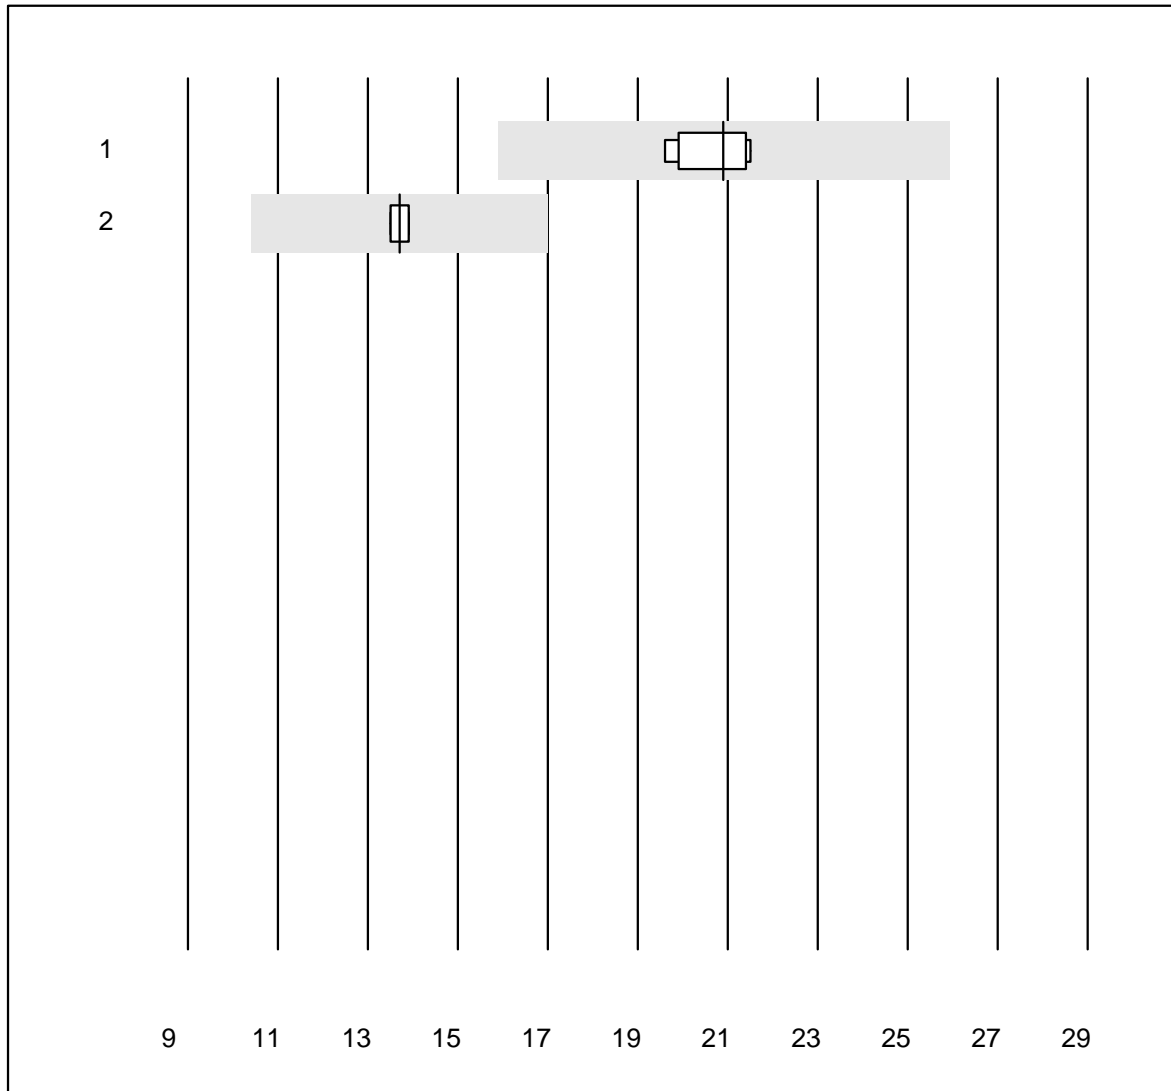


QUALAB Tolérance : 24 %

Luteinisierendes Hormon (U/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Roche, Cobas	7	100.0	0.0	0.0	20.9	3.9	e
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	13.7	1.6	e


Follikelstimulierendes Hormon

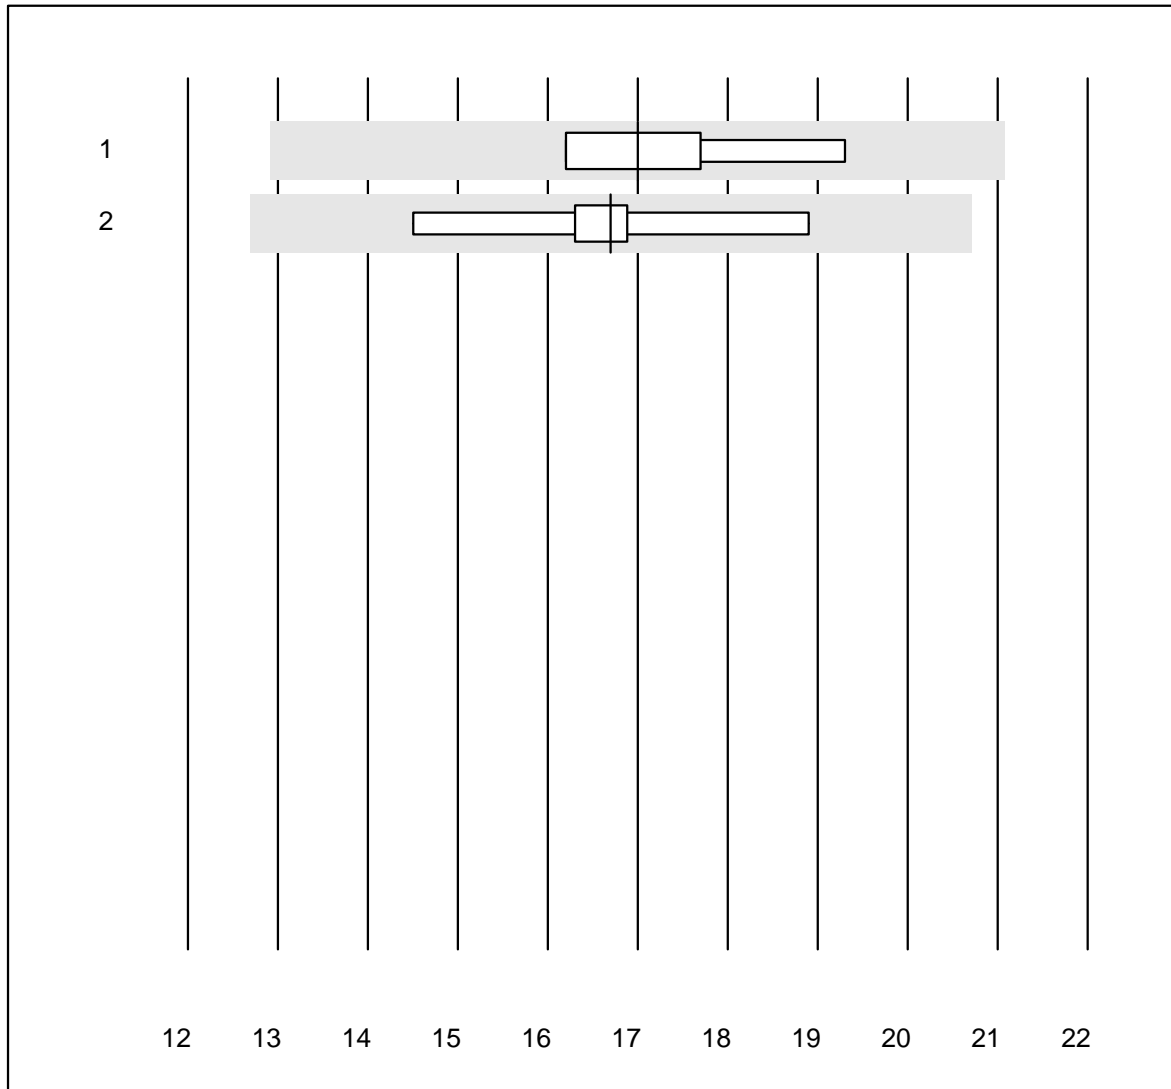

QUALAB Tolérance : 24 % Follikelstimulierendes Hormon (U/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Roche, Cobas	7	100.0	0.0	0.0	17.0	6.6	e
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	16.7	9.4	e*

Prolaktin (PRL)

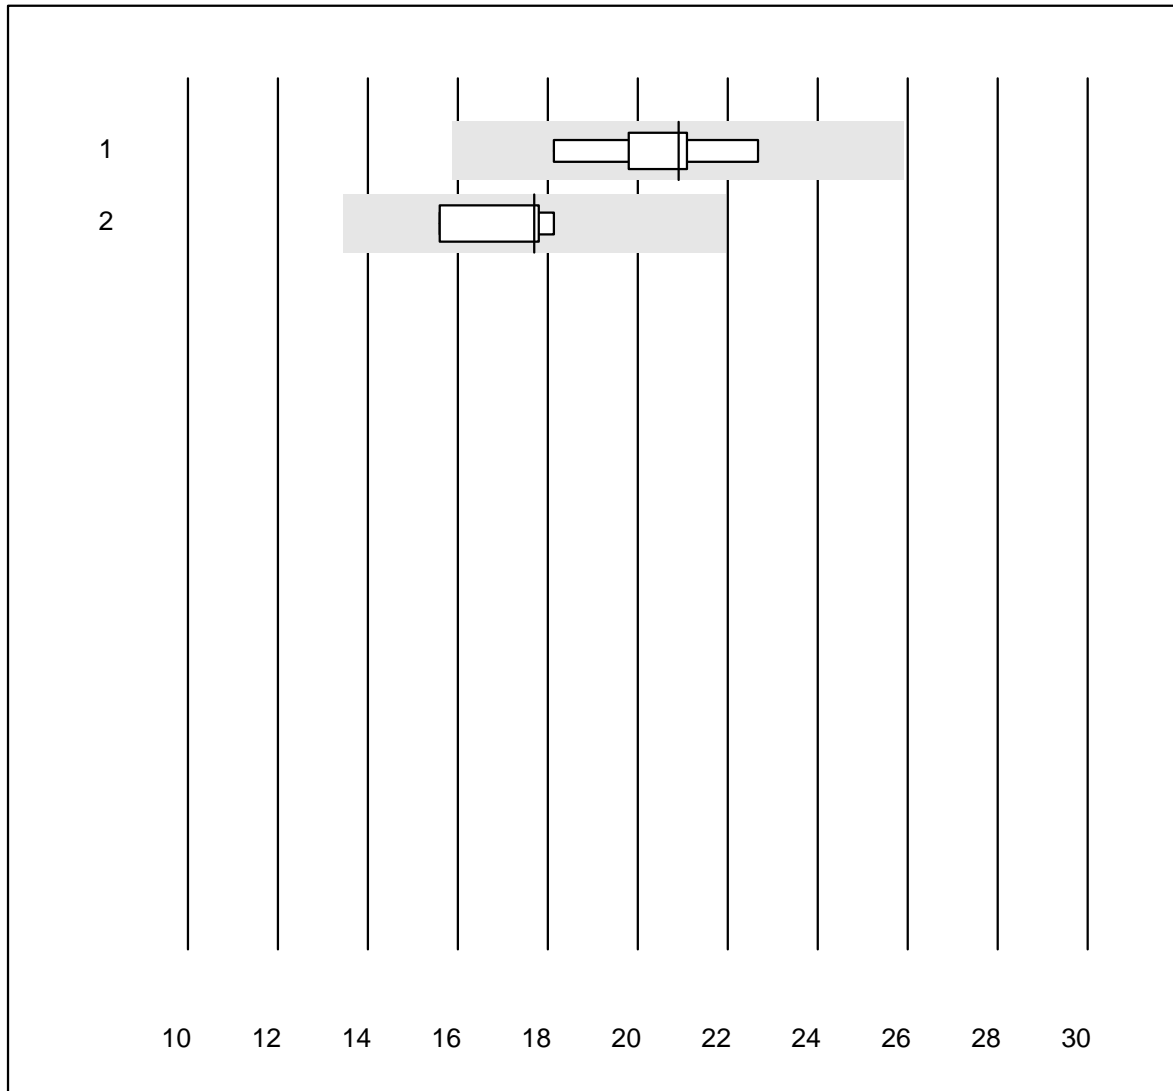


QUALAB Tolérance : 24 %

Prolaktin (PRL) (µg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas/Roche	8	100.0	0.0	0.0	20.9	6.3	e
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	17.7	6.6	e*

Insulin

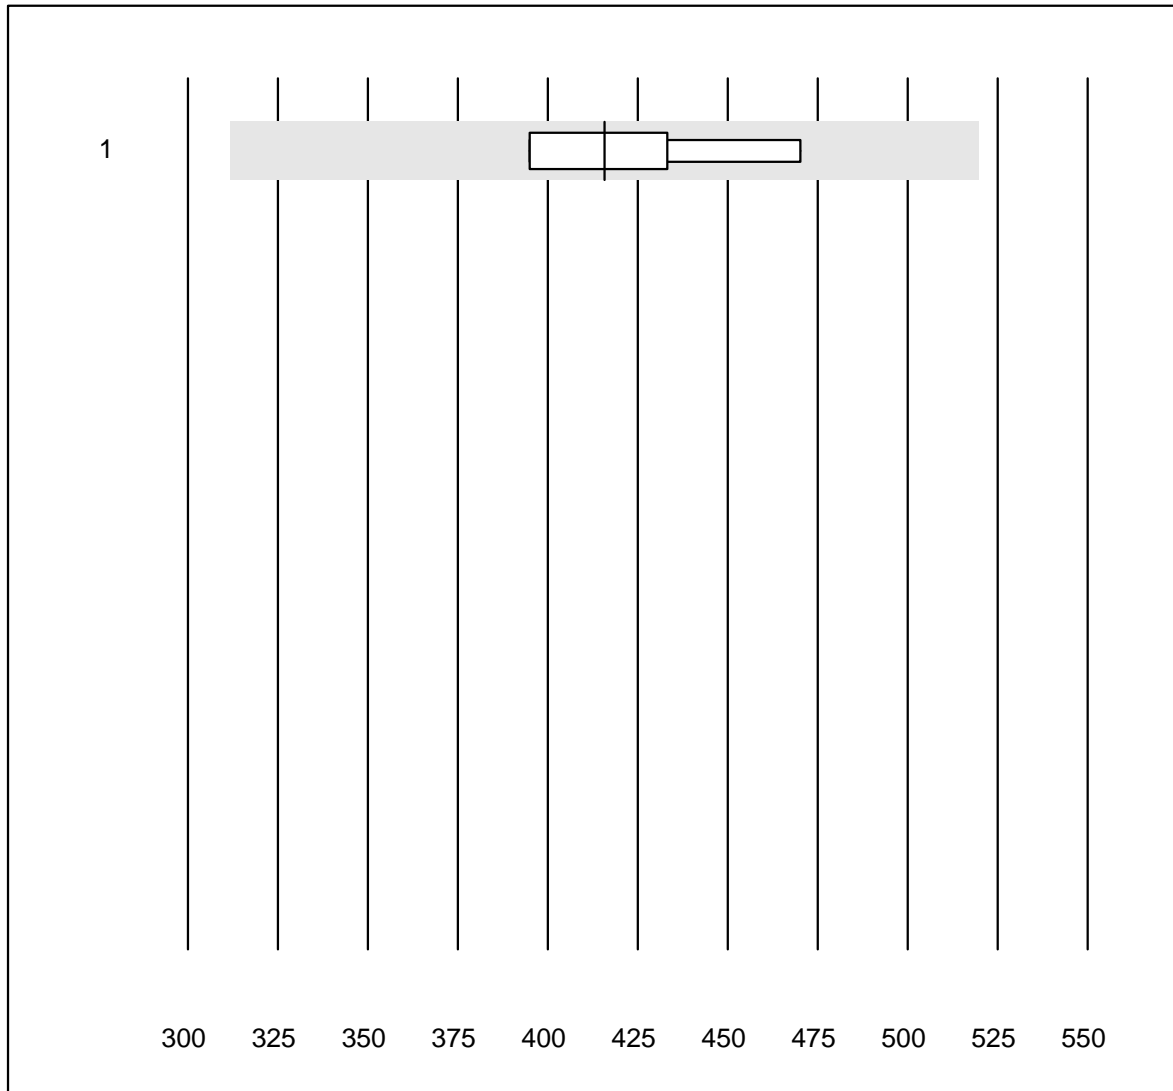


Tolérance MQ : 25 %

Insulin (pmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	416	8.3	e*

HGH

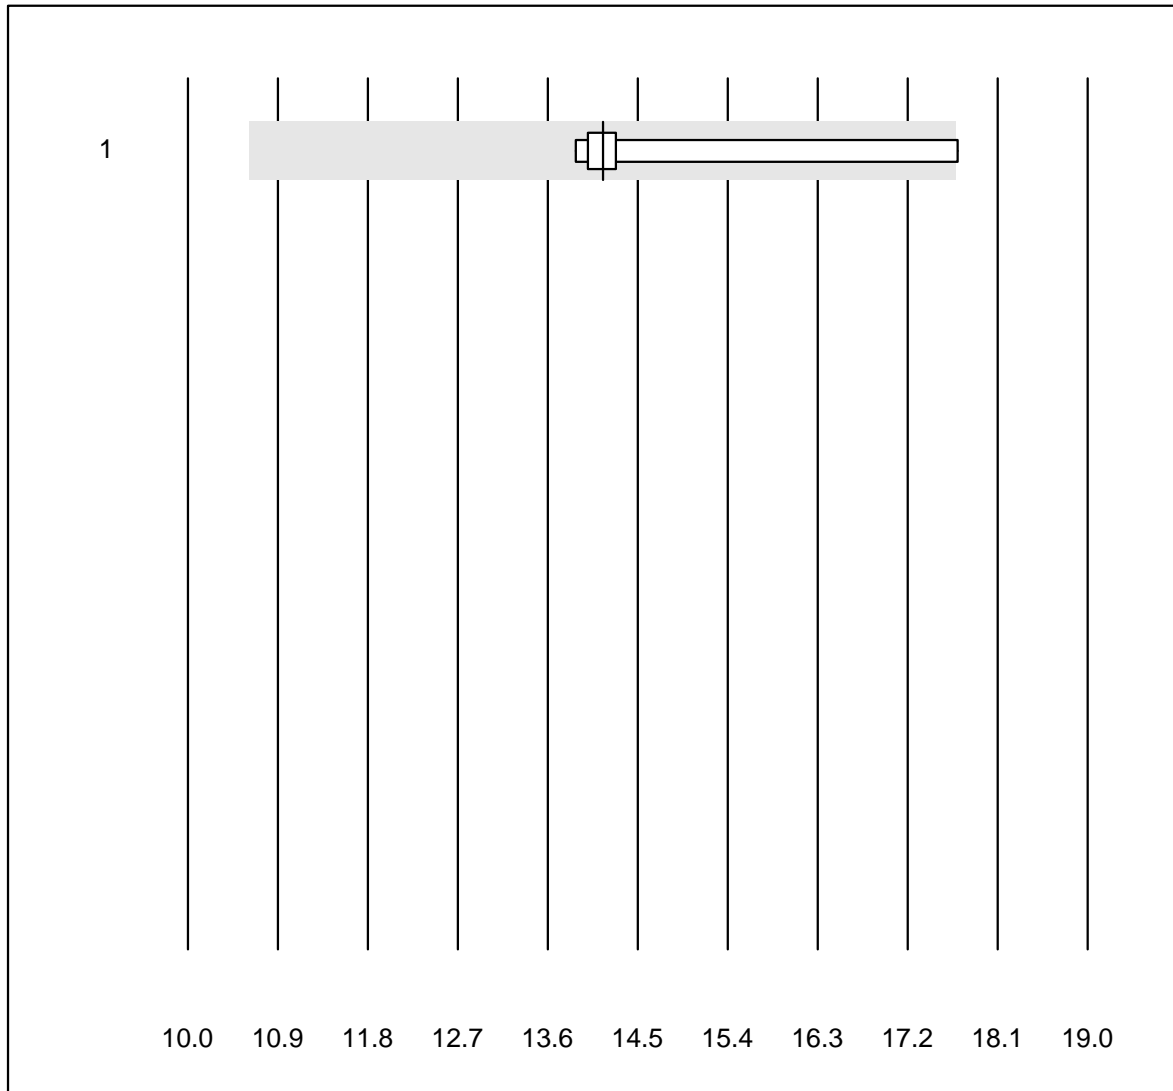


Tolérance MQ : 25 %

HGH (µg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	6	83.3	16.7	0.0	14.15	10.1	e*

Freies Testosteron

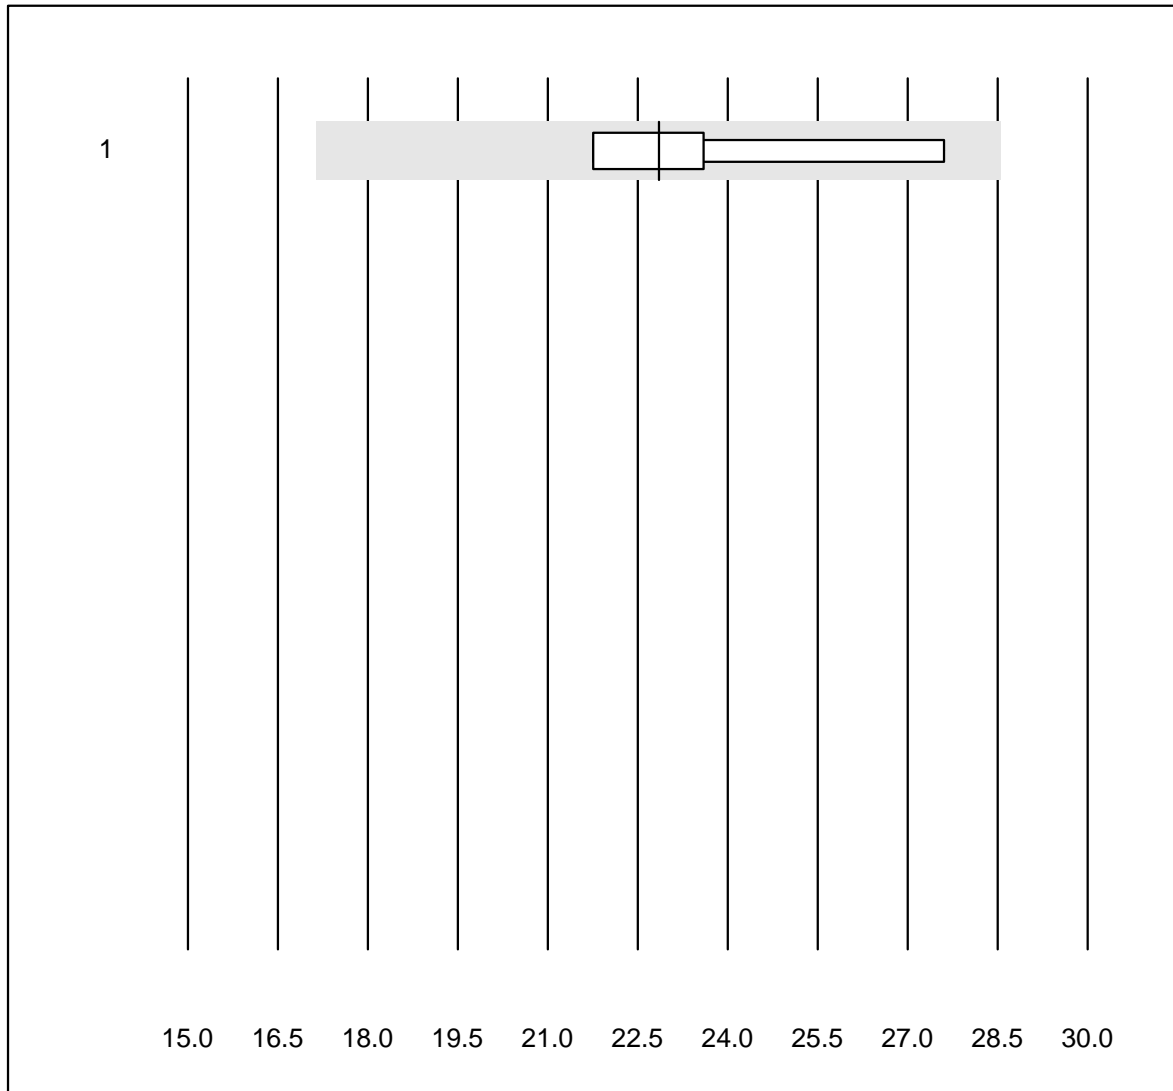


Tolérance MQ : 25 %

Freies Testosteron (pmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	22.9	11.3	e*

IGF-1

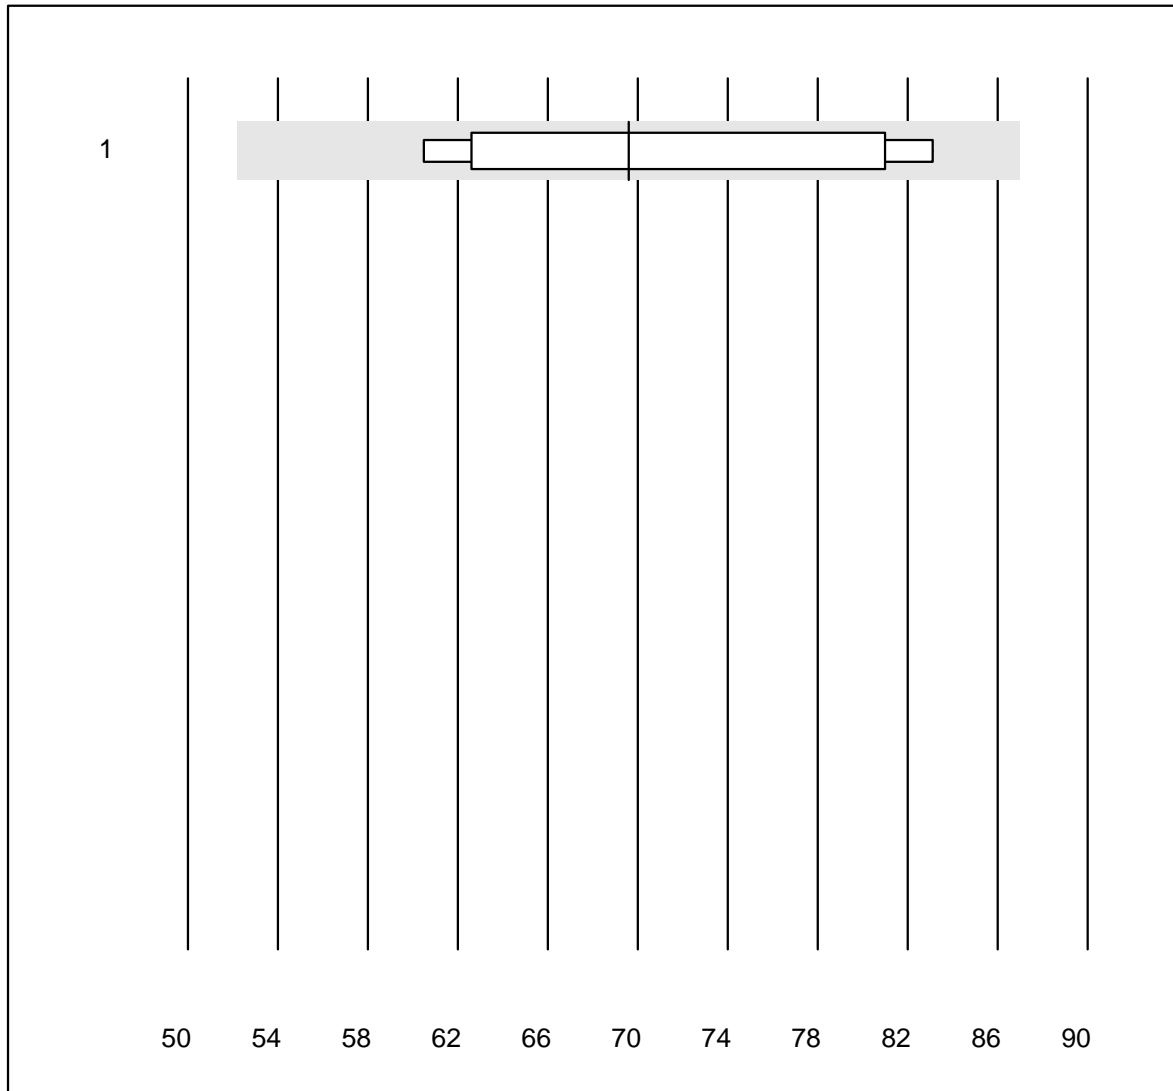


Tolérance MQ : 25 %

IGF-1 (µg/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	70	14.5	e*

Troponine T CR

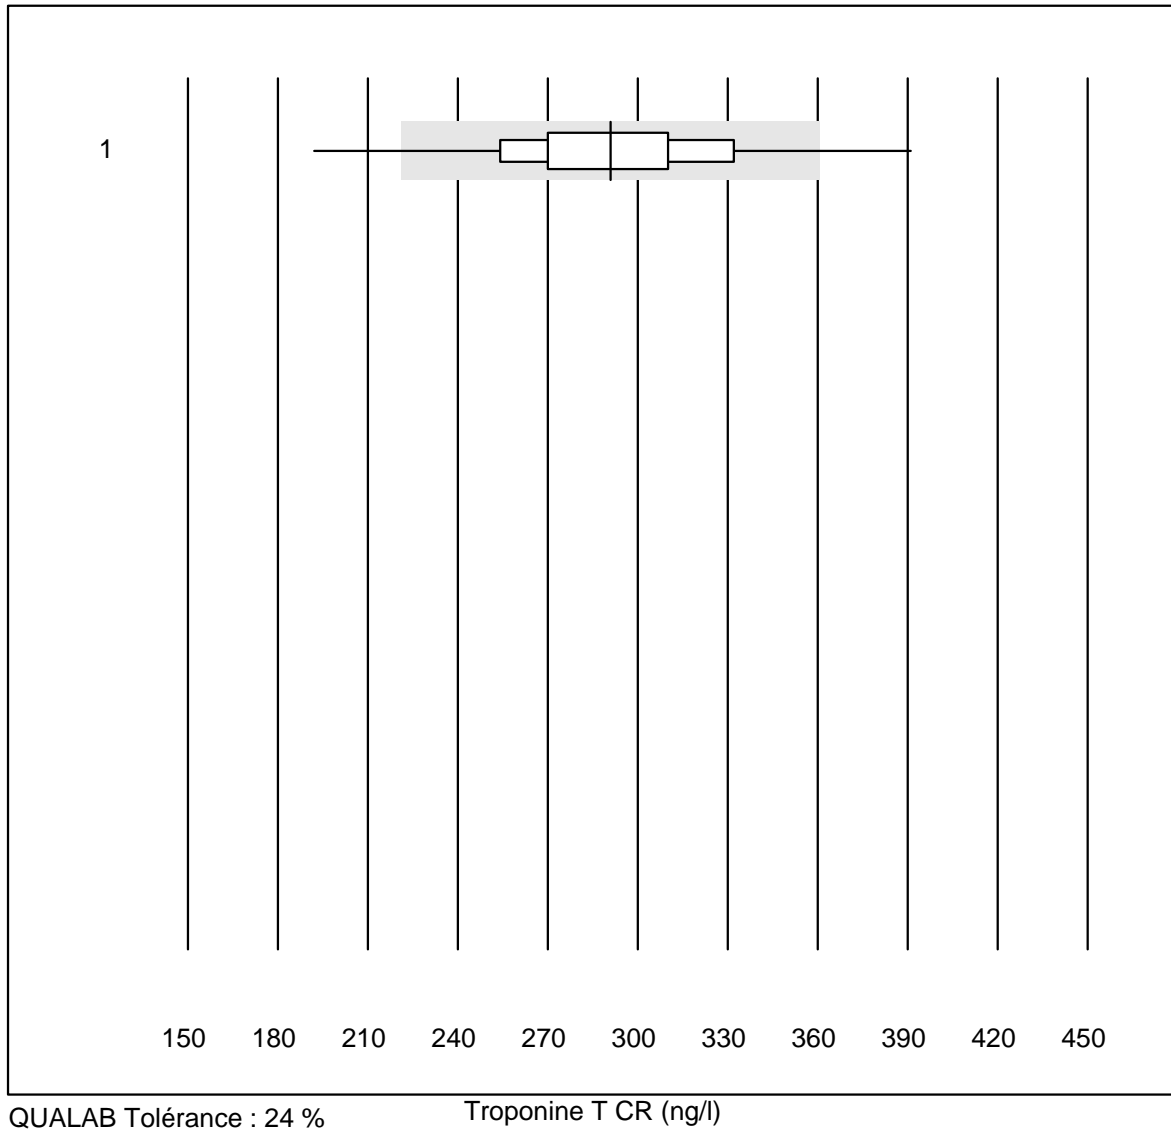

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas h 232	1312	96.0	3.3	0.7	290.94	10.8	e

D-Dimères CR

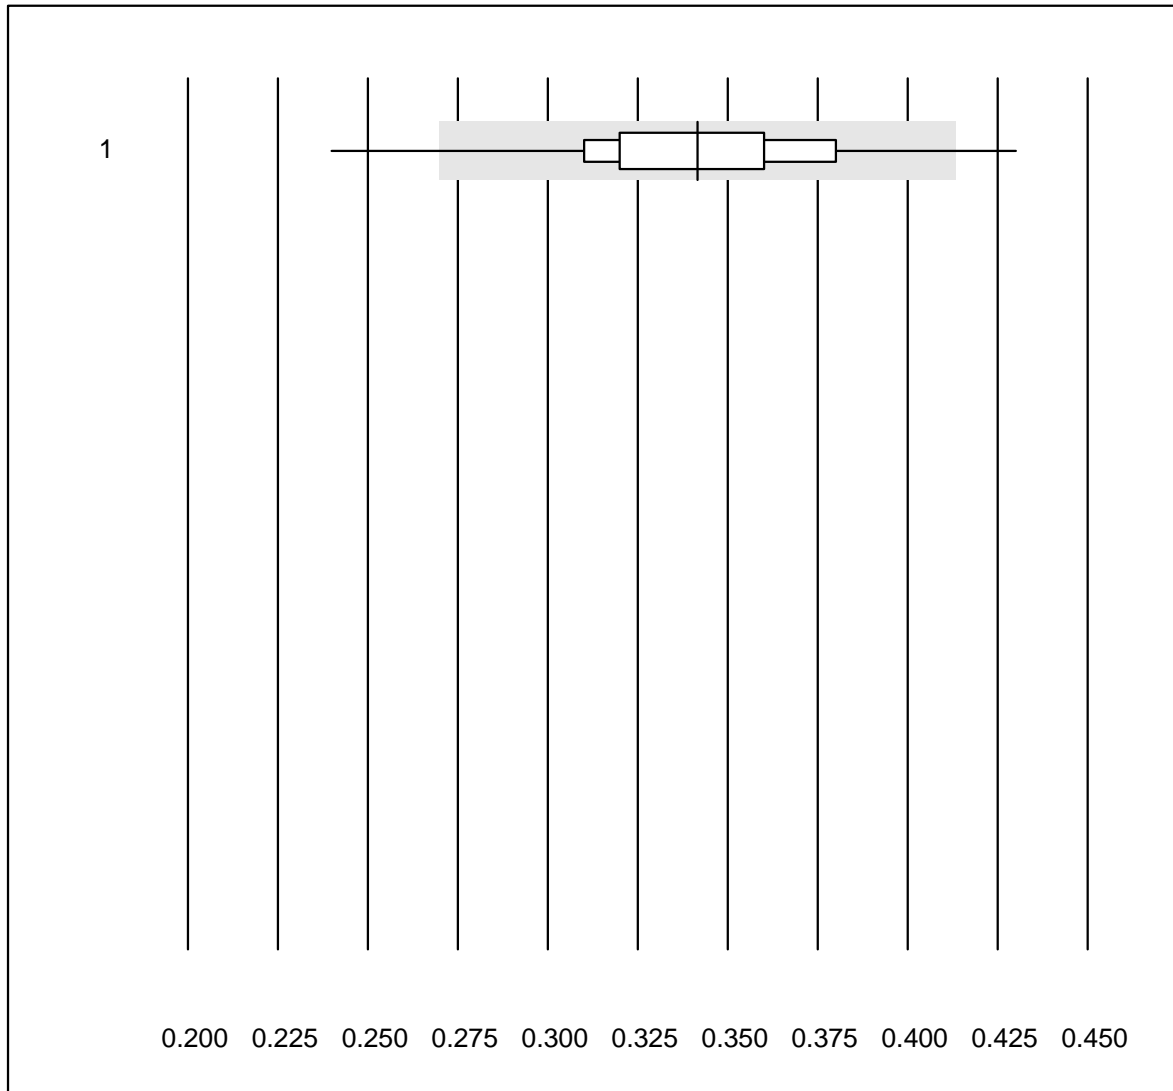


QUALAB Tolérance : 21 %

D-Dimères CR (mg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas h 232	1284	97.9	1.3	0.8	0.34	8.4	e

CKMB- K8

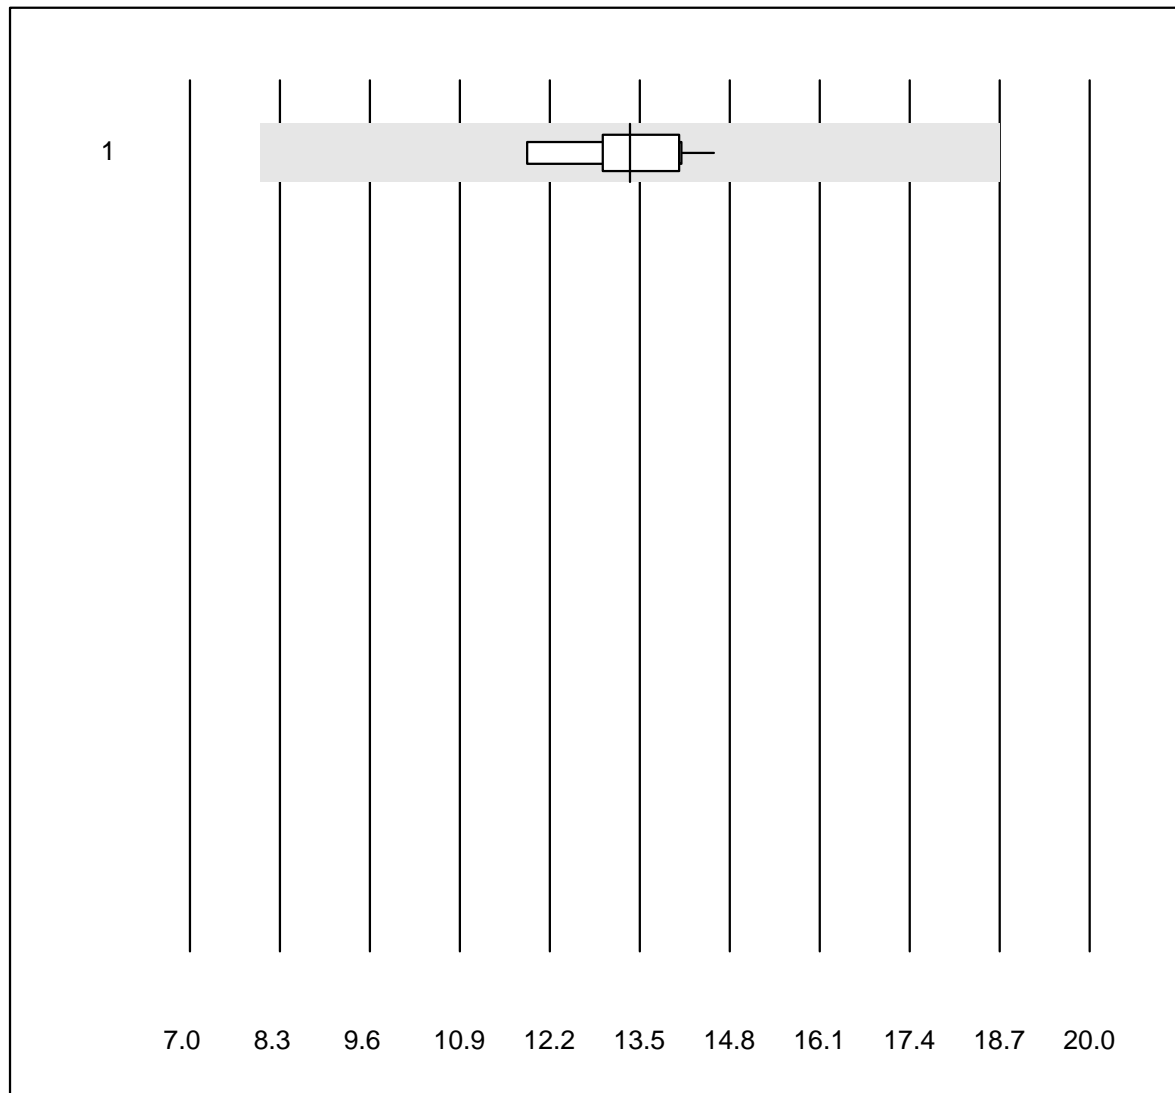


Tolérance MQ : 40 %

CKMB- K8 (µg/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas h 232	10	100.0	0.0	0.0	13.4	6.6	e

NT-proBNP CR

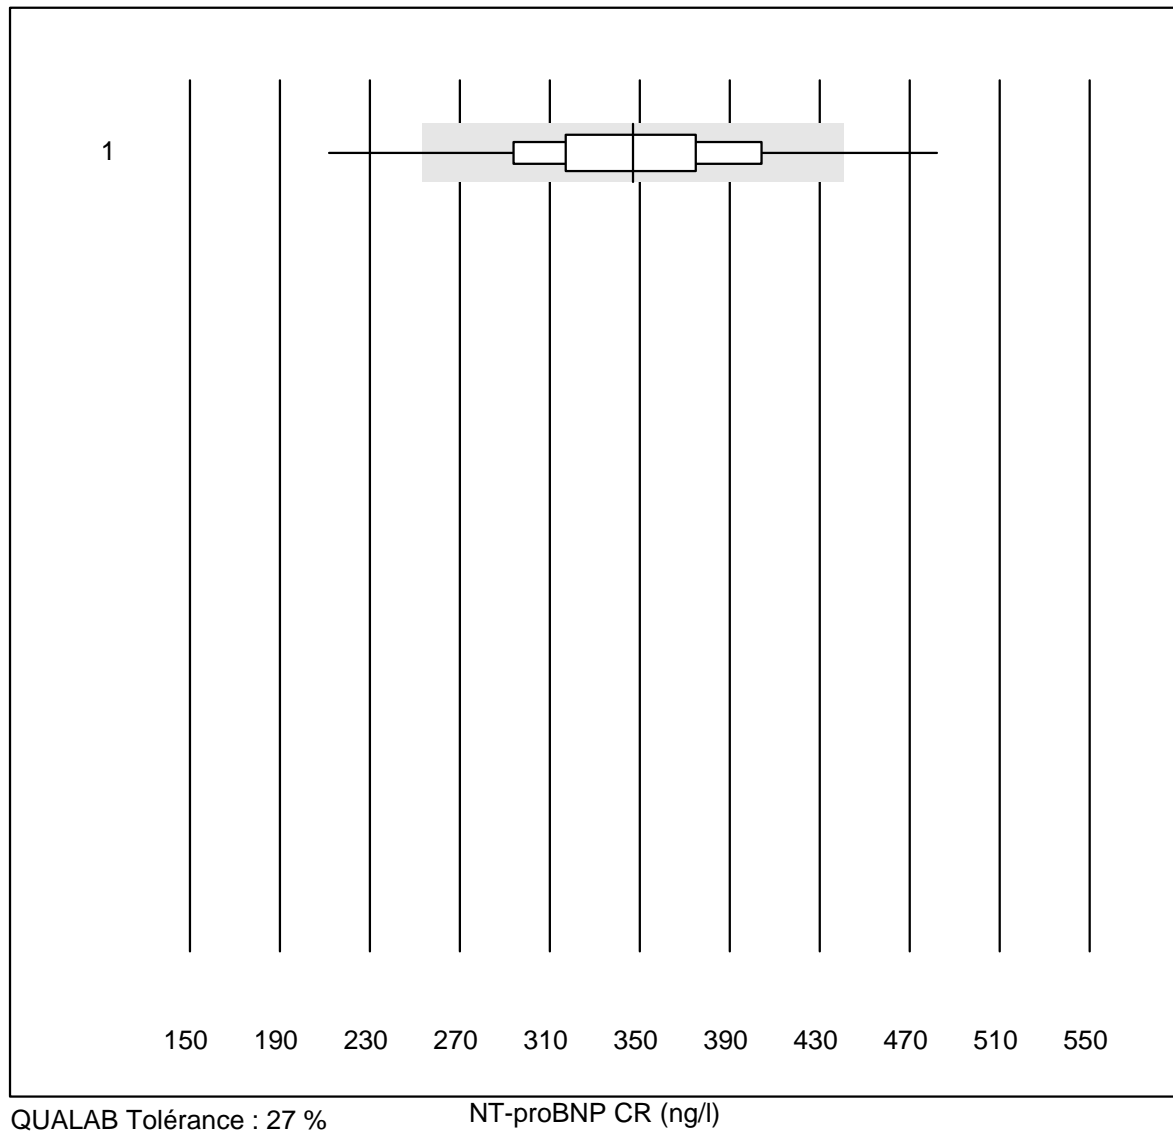

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas h 232	819	96.8	2.7	0.5	347	12.3	e

PCO2 CCA

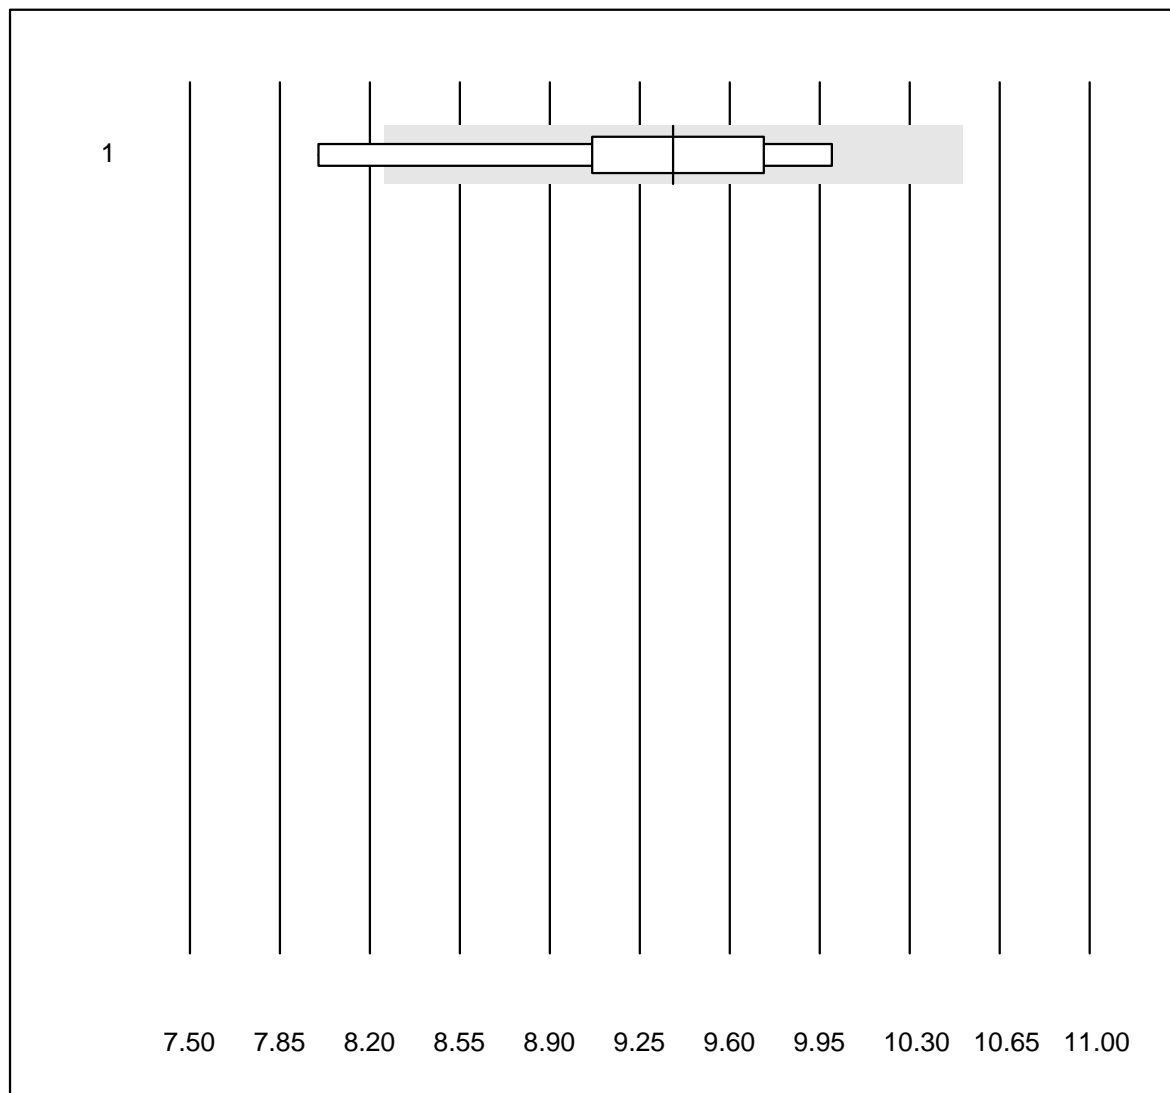


QUALAB Tolérance : 12 %

PCO2 CCA (kPa)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 OPTI CCA	10	80.0	10.0	10.0	9.38	6.5	e*

PO2 CCA

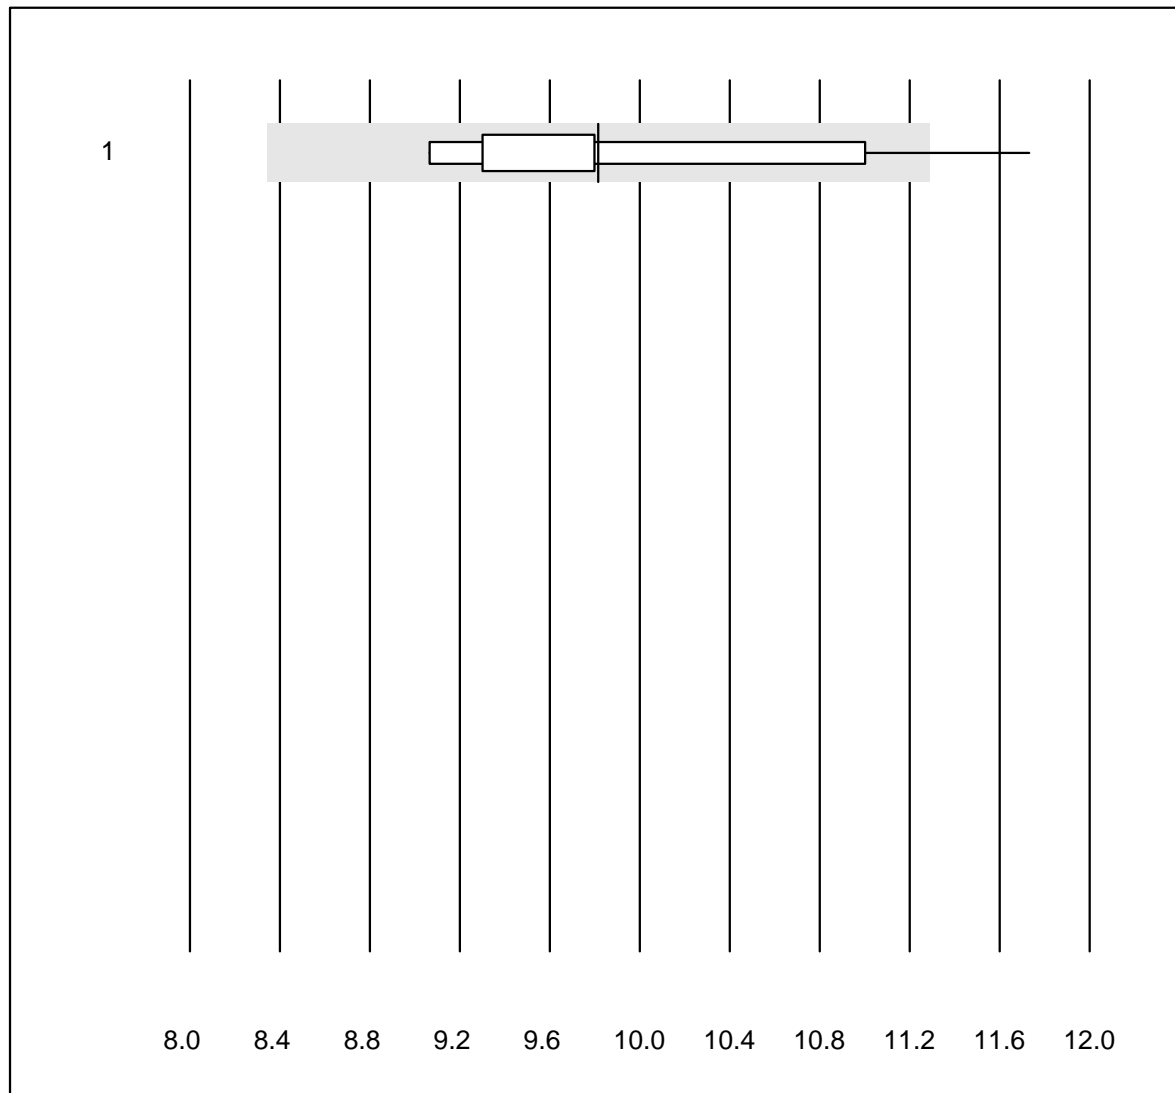


QUALAB Tolérance : 15 %

PO2 CCA (kPa)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 OPTI CCA	10	90.0	10.0	0.0	9.82	8.8	e*

pH CCA

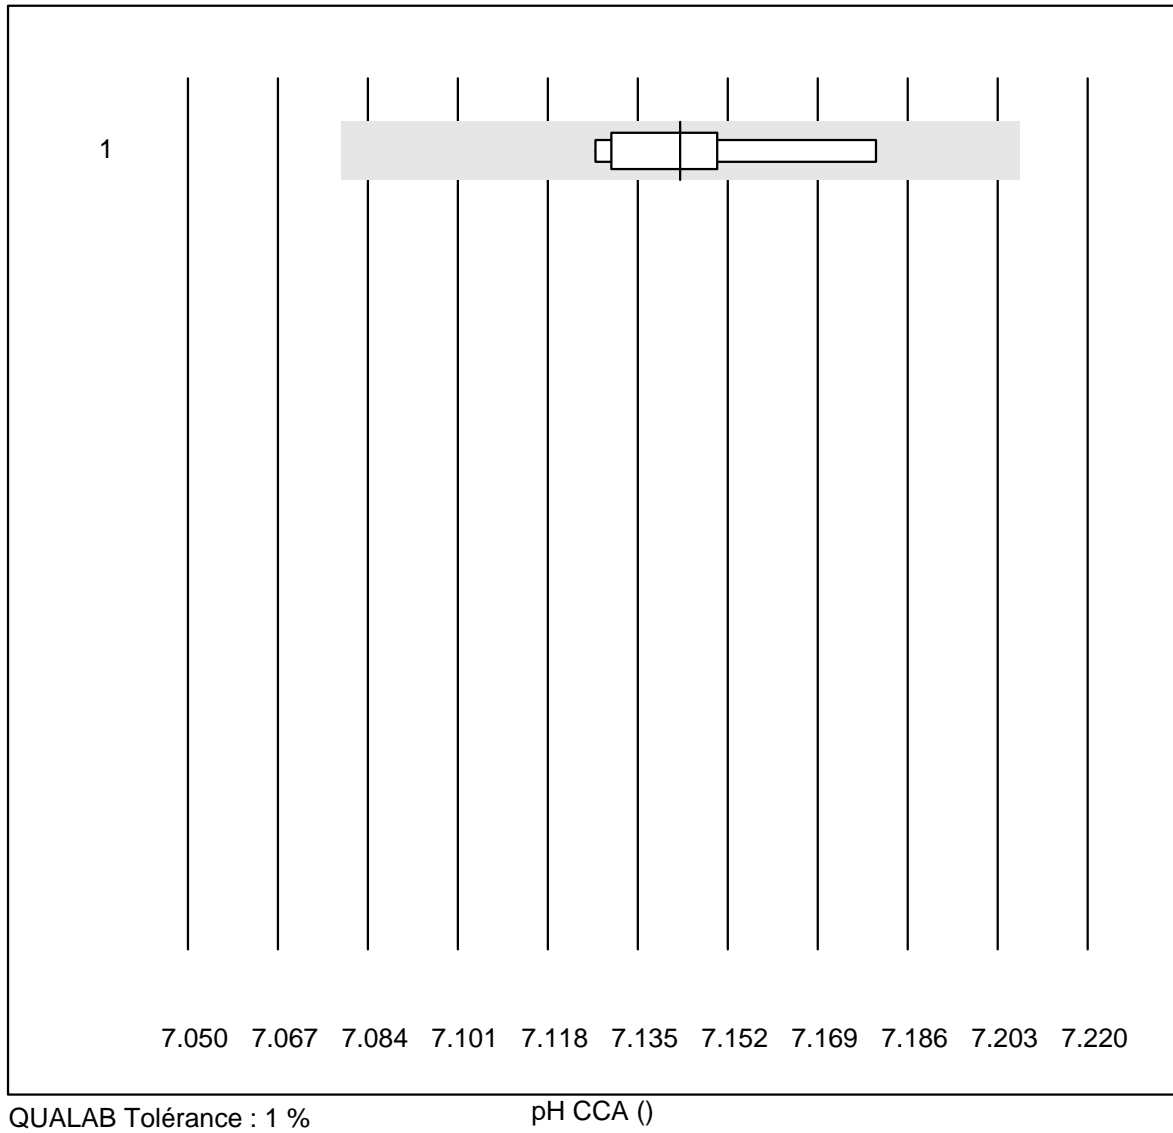

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 OPTI CCA	9	100.0	0.0	0.0	7.14	0.2	e

Potassium CCA

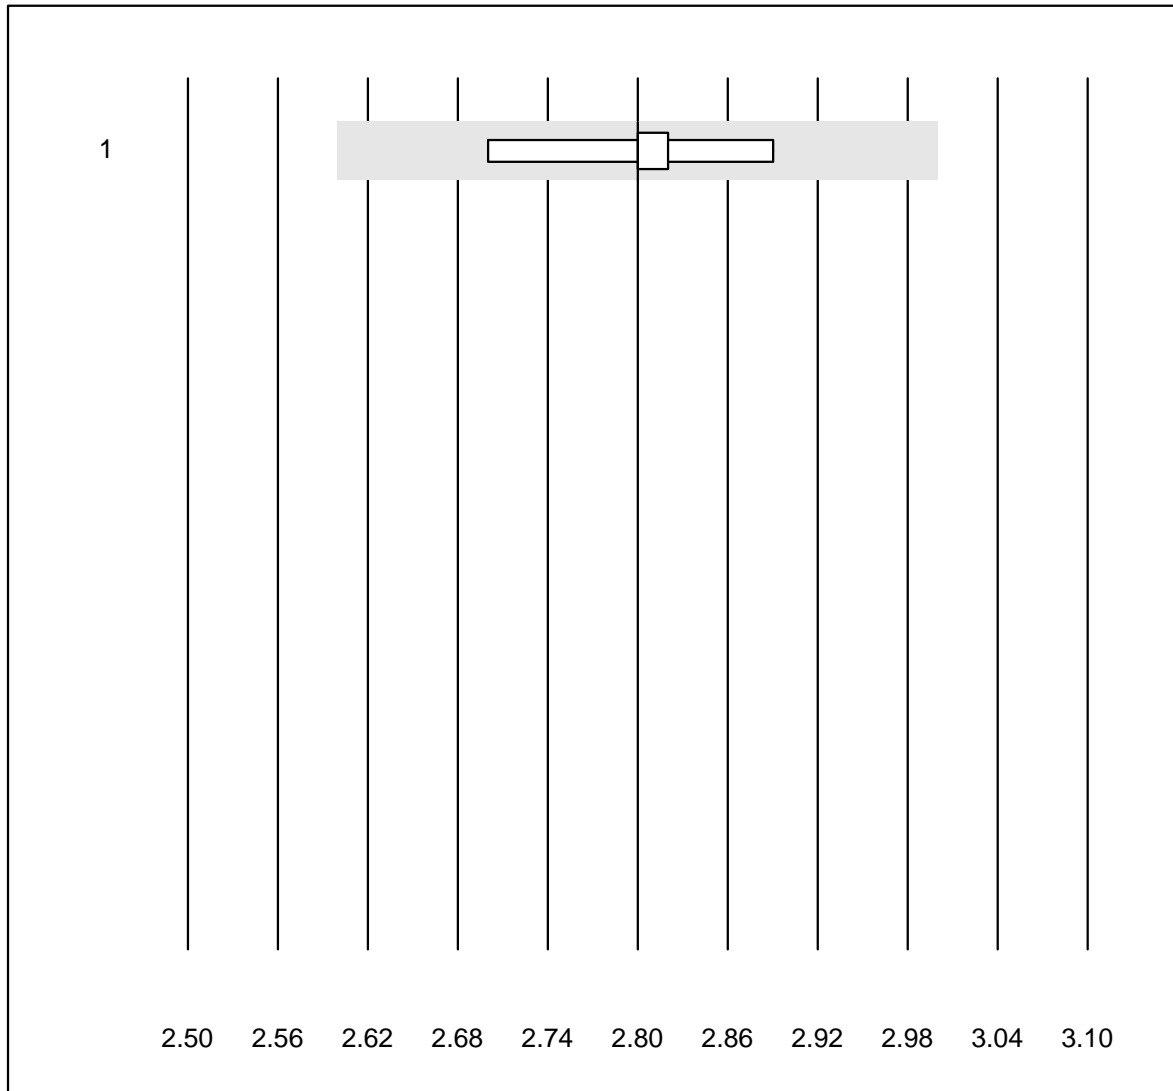


QUALAB Tolérance : 6 %
(< 3.3: +/- 0.2 mmol/l)

Potassium CCA (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 OPTI CCA	5	100.0	0.0	0.0	2.8	2.4	e*

Sodium CCA

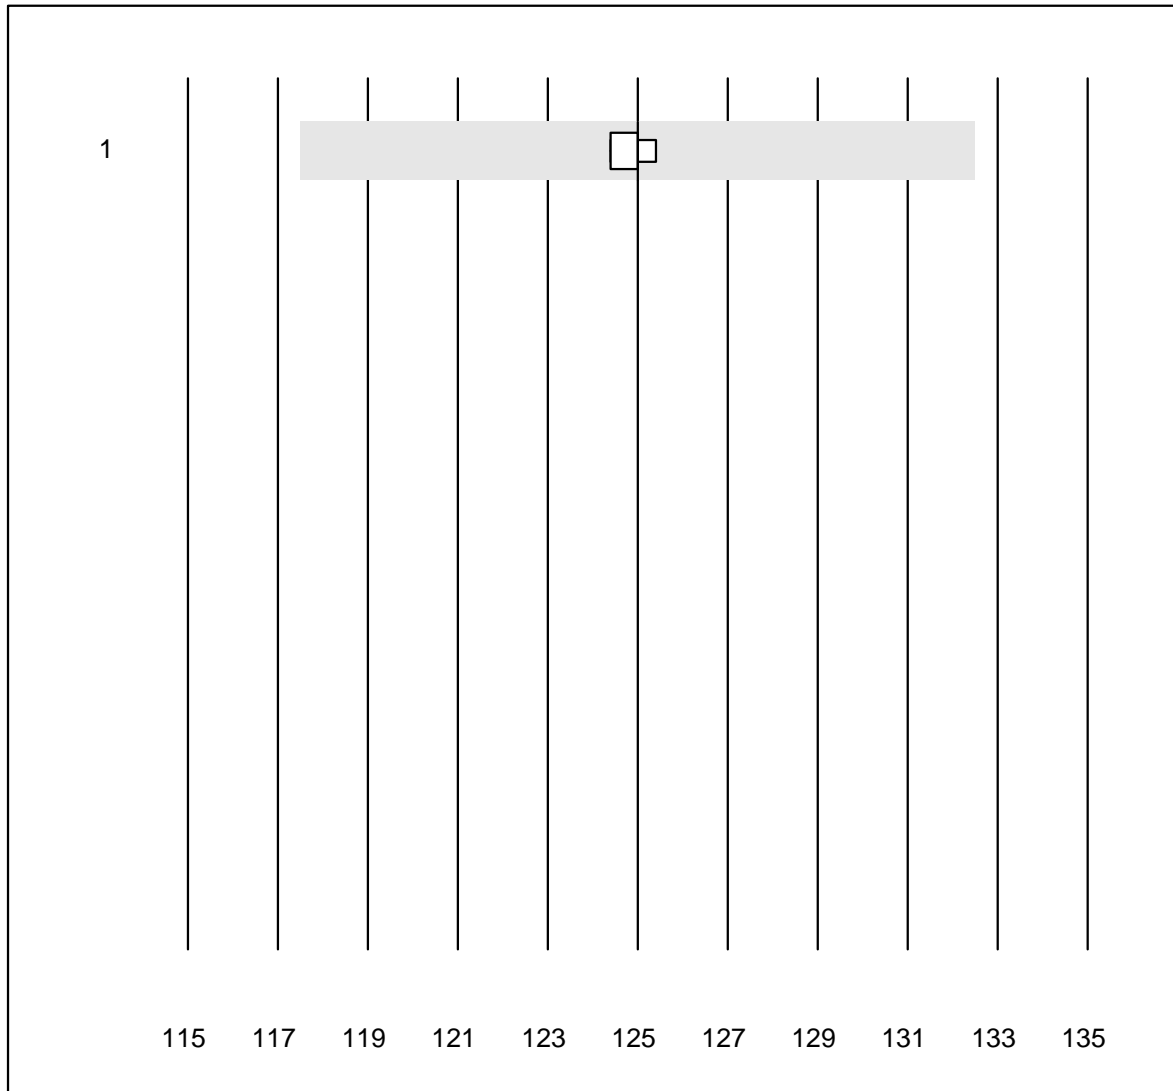


QUALAB Tolérance : 6 %

Sodium CCA (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 OPTI CCA	4	100.0	0.0	0.0	125.0	0.3	e

Ferritine

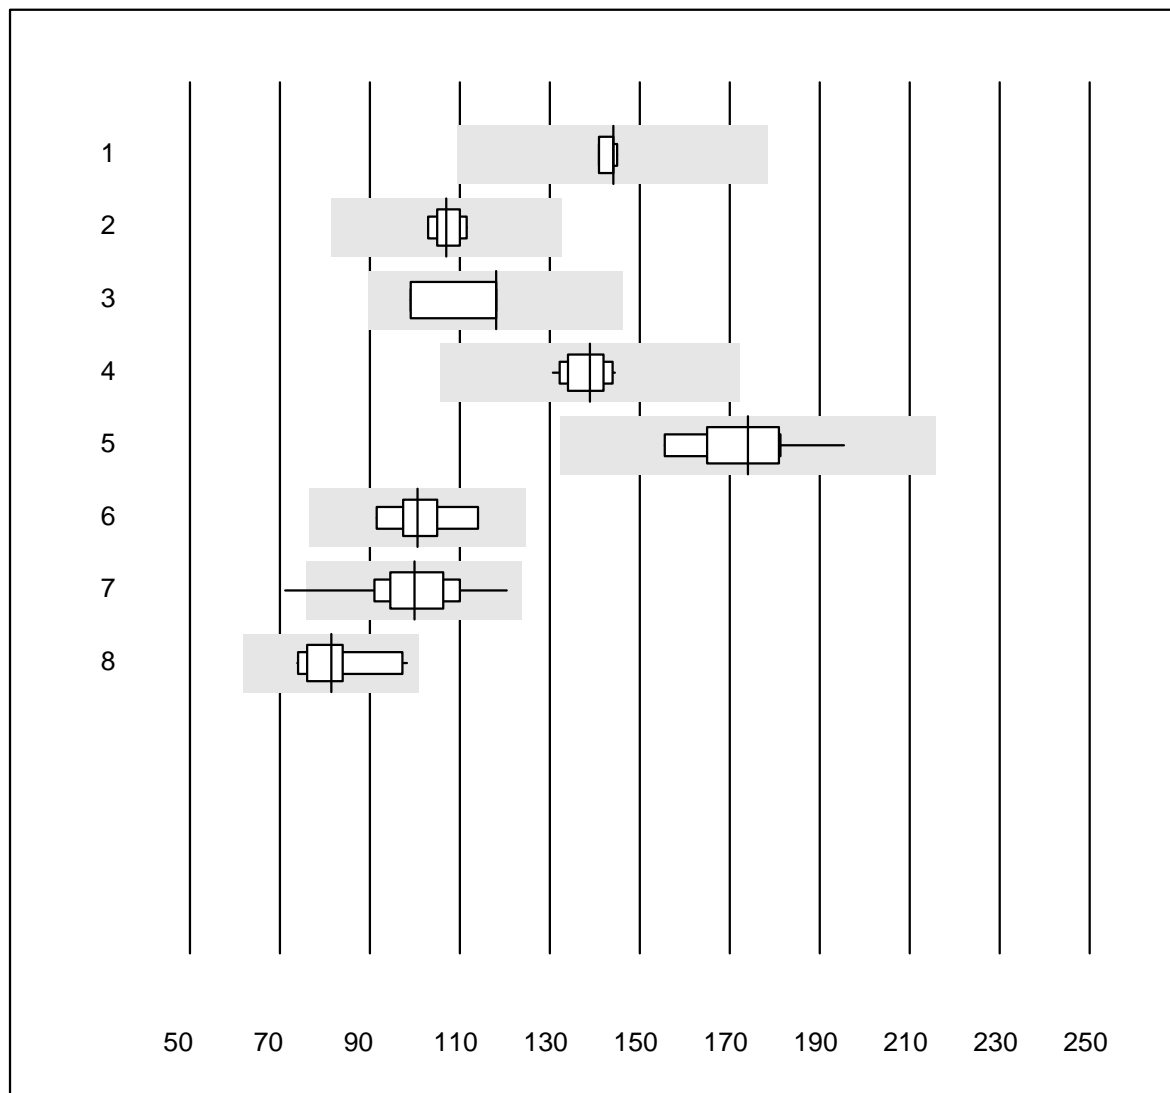


QUALAB Tolérance : 24 %

Ferritine (µg/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1	Dimension	4	100.0	0.0	0.0	144.08	1.2	e
2	Beckman	6	100.0	0.0	0.0	107.05	3.0	e
3	toutes les méthodes	5	60.0	0.0	40.0	118.00	9.8	a
4	Cobas E / Elecsys	16	100.0	0.0	0.0	138.89	3.2	e
5	Architect	10	100.0	0.0	0.0	174.00	6.6	e
6	Mini Vidas	8	100.0	0.0	0.0	100.66	6.6	e
7	AFIAS	42	97.6	2.4	0.0	99.84	8.8	e
8	Eurolyser	20	95.0	0.0	5.0	81.43	8.2	e

Vitamine B12

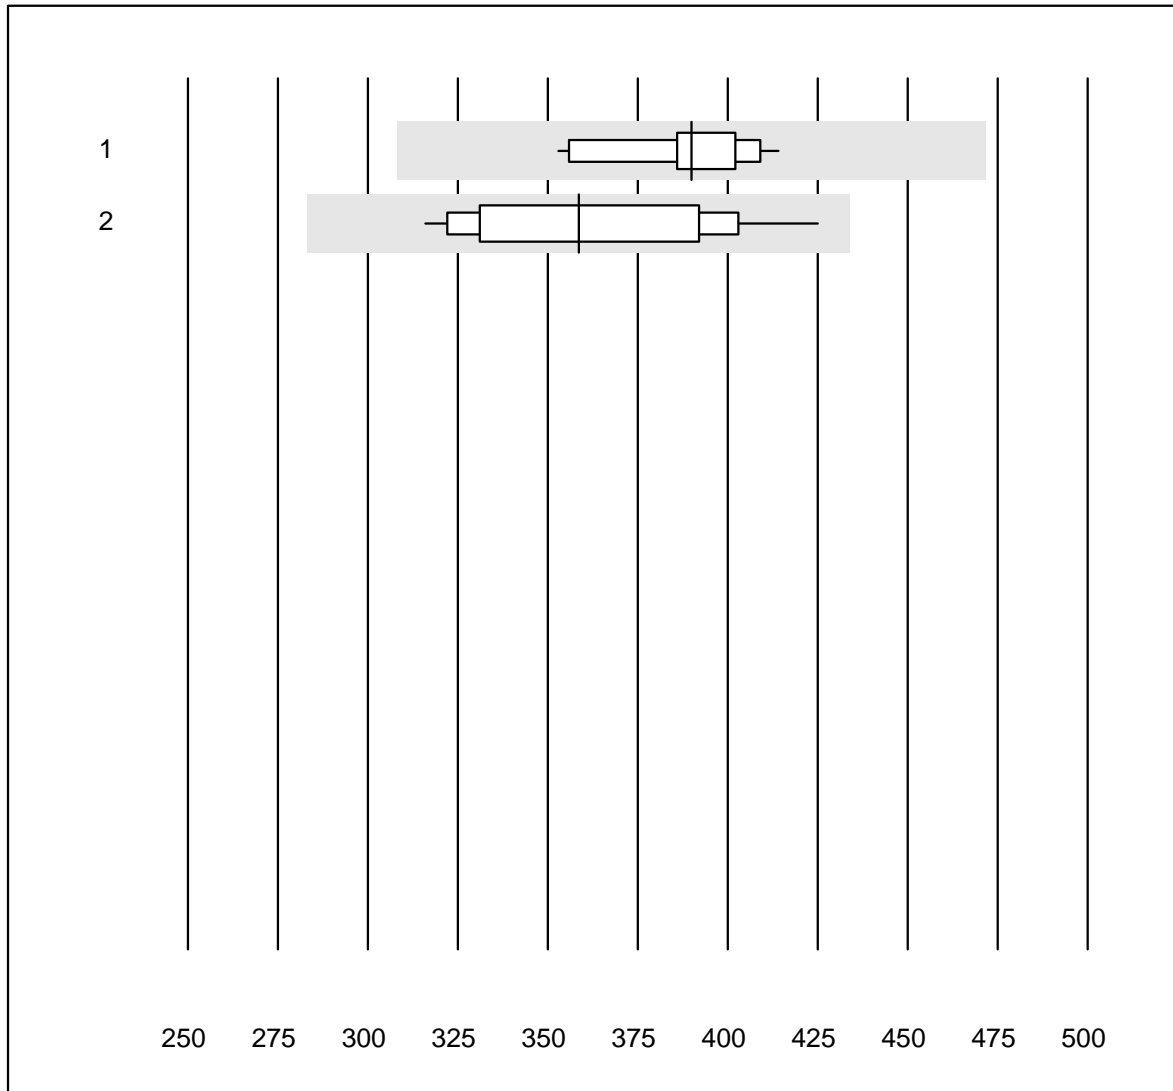


QUALAB Tolérance : 21 %

Vitamine B12 (pmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas E / Elecsys	13	100.0	0.0	0.0	390.01	4.7	e
2 Architect	11	100.0	0.0	0.0	358.51	10.1	e*

Folate

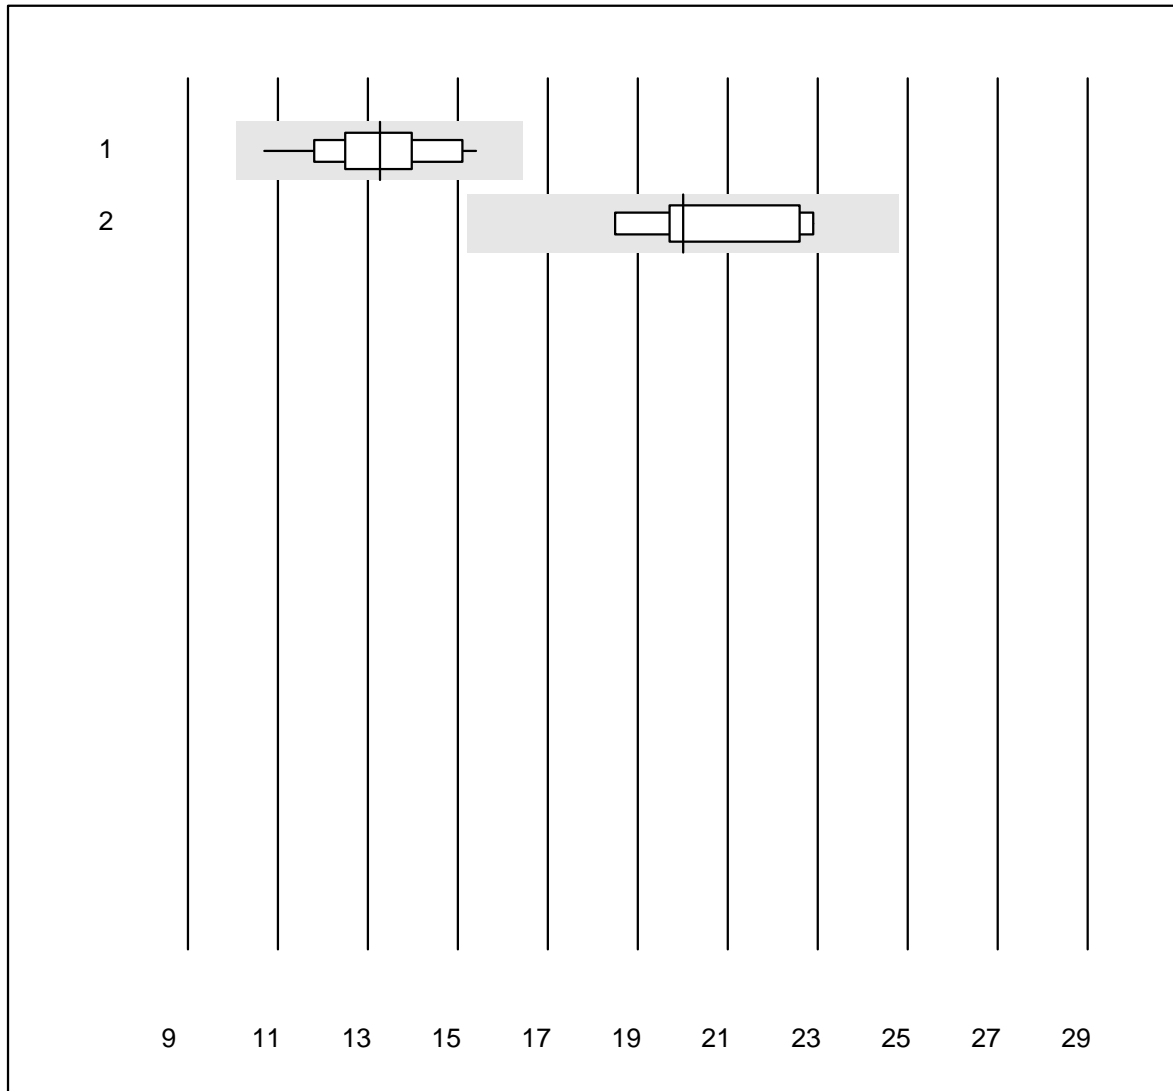


QUALAB Tolérance : 24 %

Folate (nmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas E / Elecsys	15	100.0	0.0	0.0	13.26	9.1	e
2 Architect	9	100.0	0.0	0.0	20.00	8.1	e

Holotranscobalamine

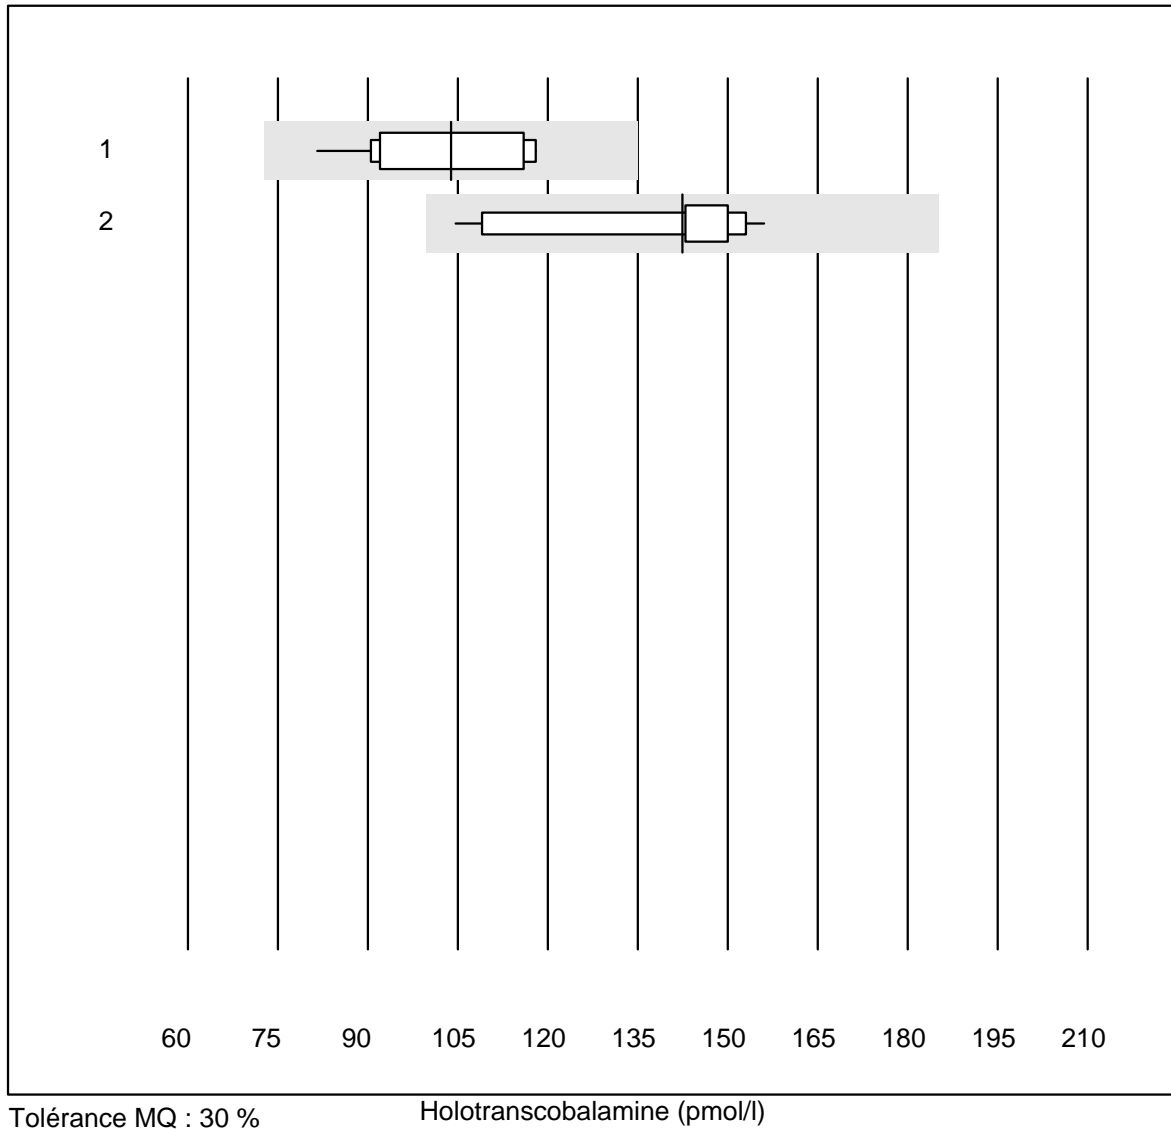


Tolérance MQ : 30 %

Holotranscobalamine (pmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Architect	11	100.0	0.0	0.0	103.9	12.2	e*
2 toutes les méthodes	19	100.0	0.0	0.0	142.5	10.9	e

Bilirubin totale Neo

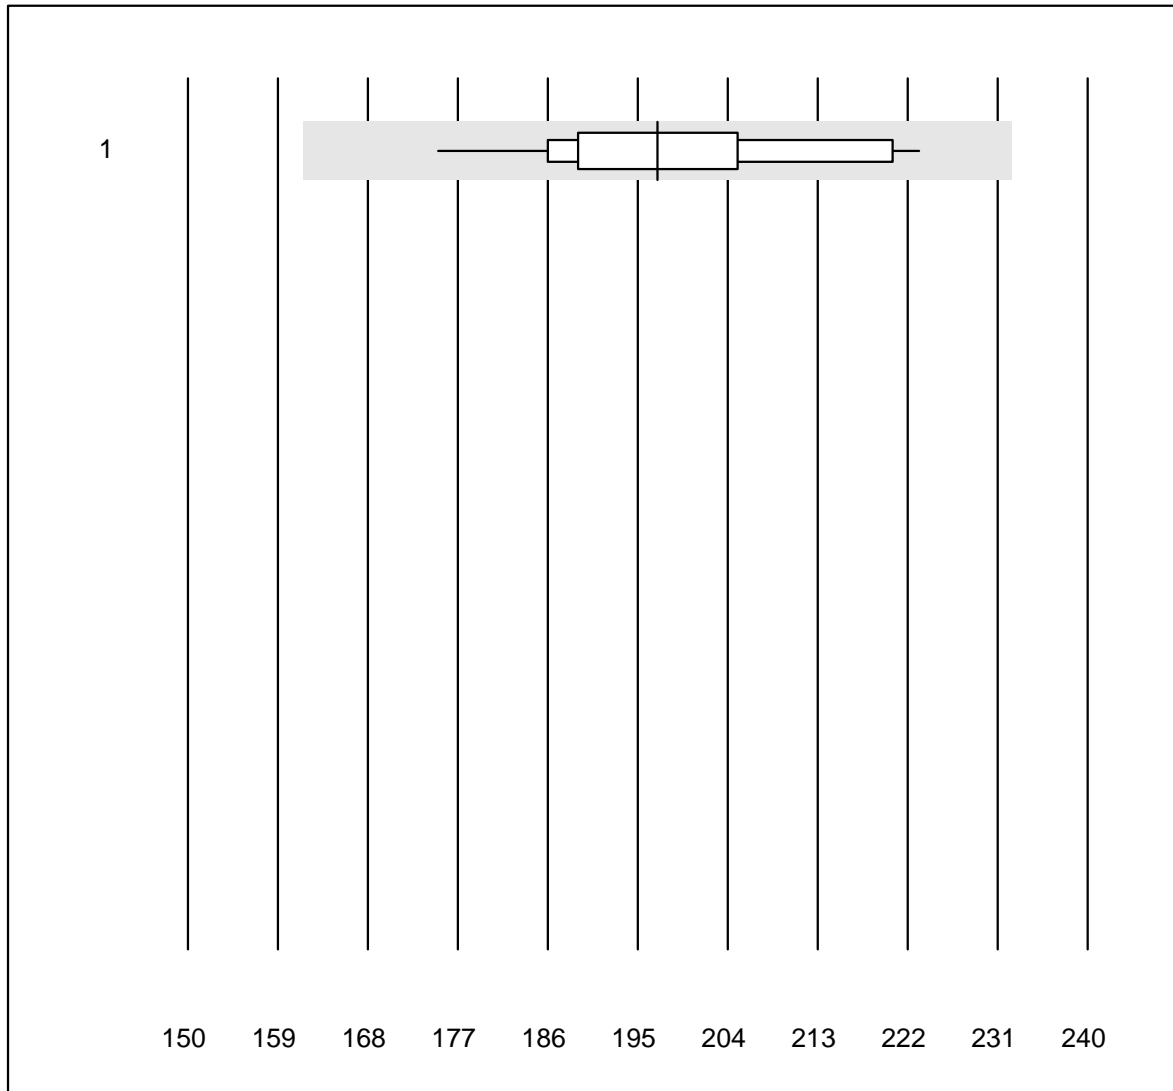


QUALAB Tolérance : 18 %

Bilirubin totale Neo (µmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	15	100.0	0.0	0.0	197	6.6	e

Bilirubin directe

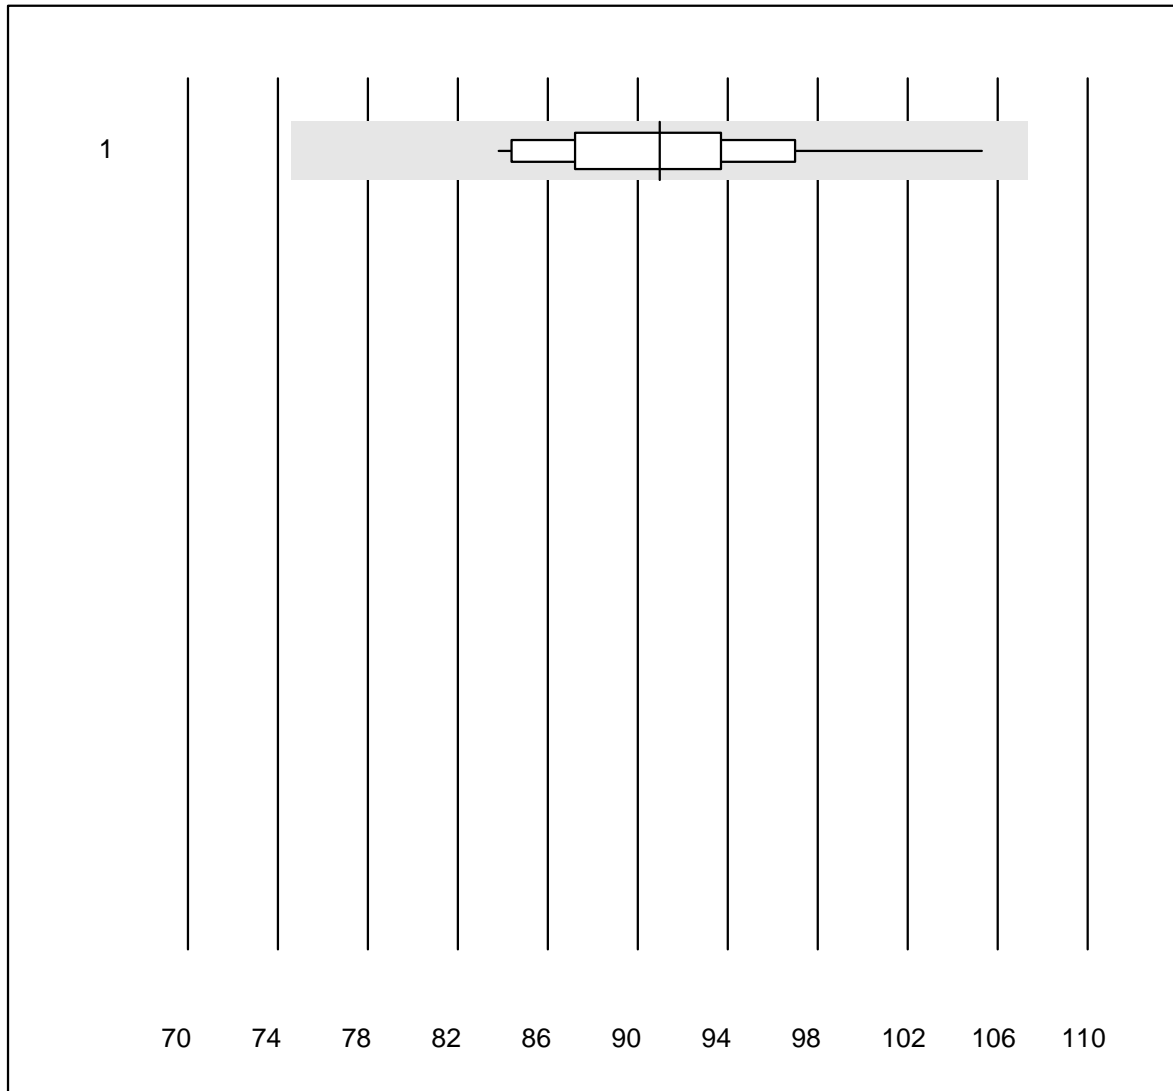


QUALAB Tolérance : 18 %

Bilirubin directe (µmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	14	100.0	0.0	0.0	91	6.4	e

Bilirubin néonatale

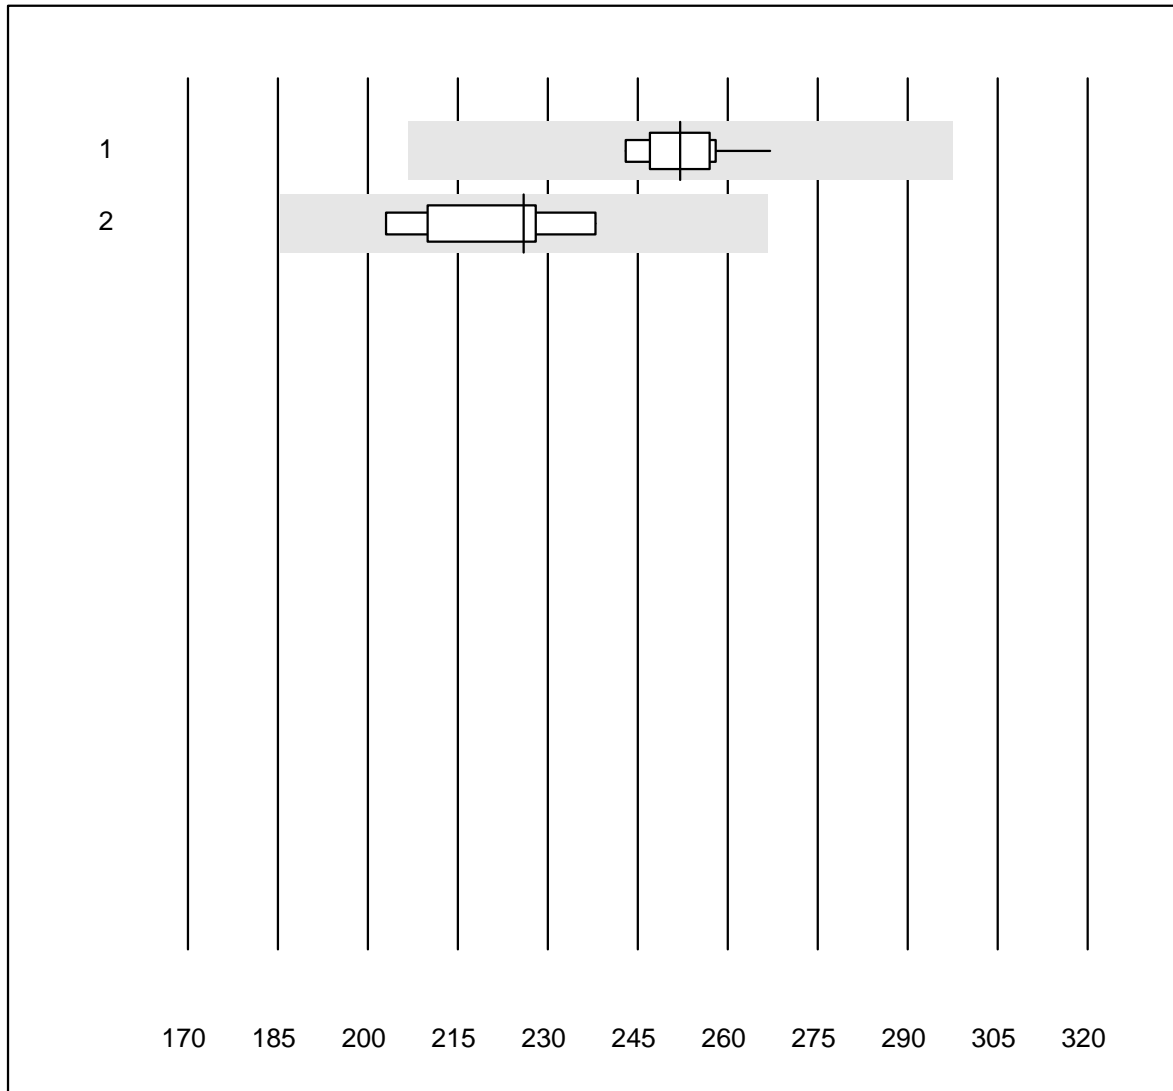


QUALAB Tolérance : 18 %

Bilirubin néonatale ($\mu\text{mol/l}$)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	10	100.0	0.0	0.0	252	2.9	e
2 ABL700/800	9	100.0	0.0	0.0	226	5.4	e

PSA

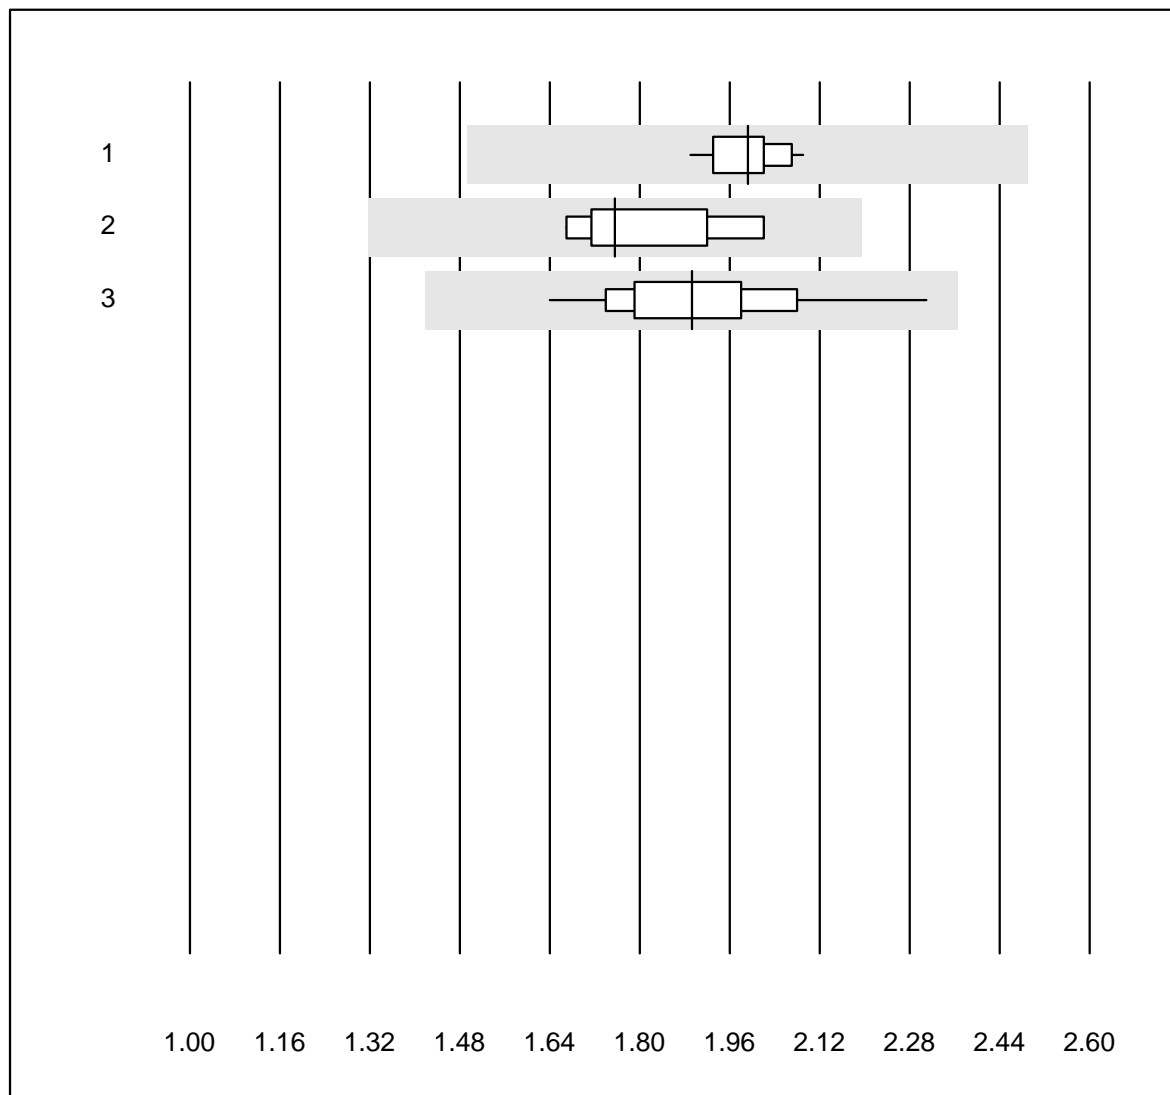


QUALAB Tolérance : 25 %

PSA (µg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas E / Elecsys	15	100.0	0.0	0.0	1.99	2.9	e
2 Architect	7	100.0	0.0	0.0	1.76	7.0	e
3 AFIAS	31	100.0	0.0	0.0	1.89	7.5	e

PSA frei

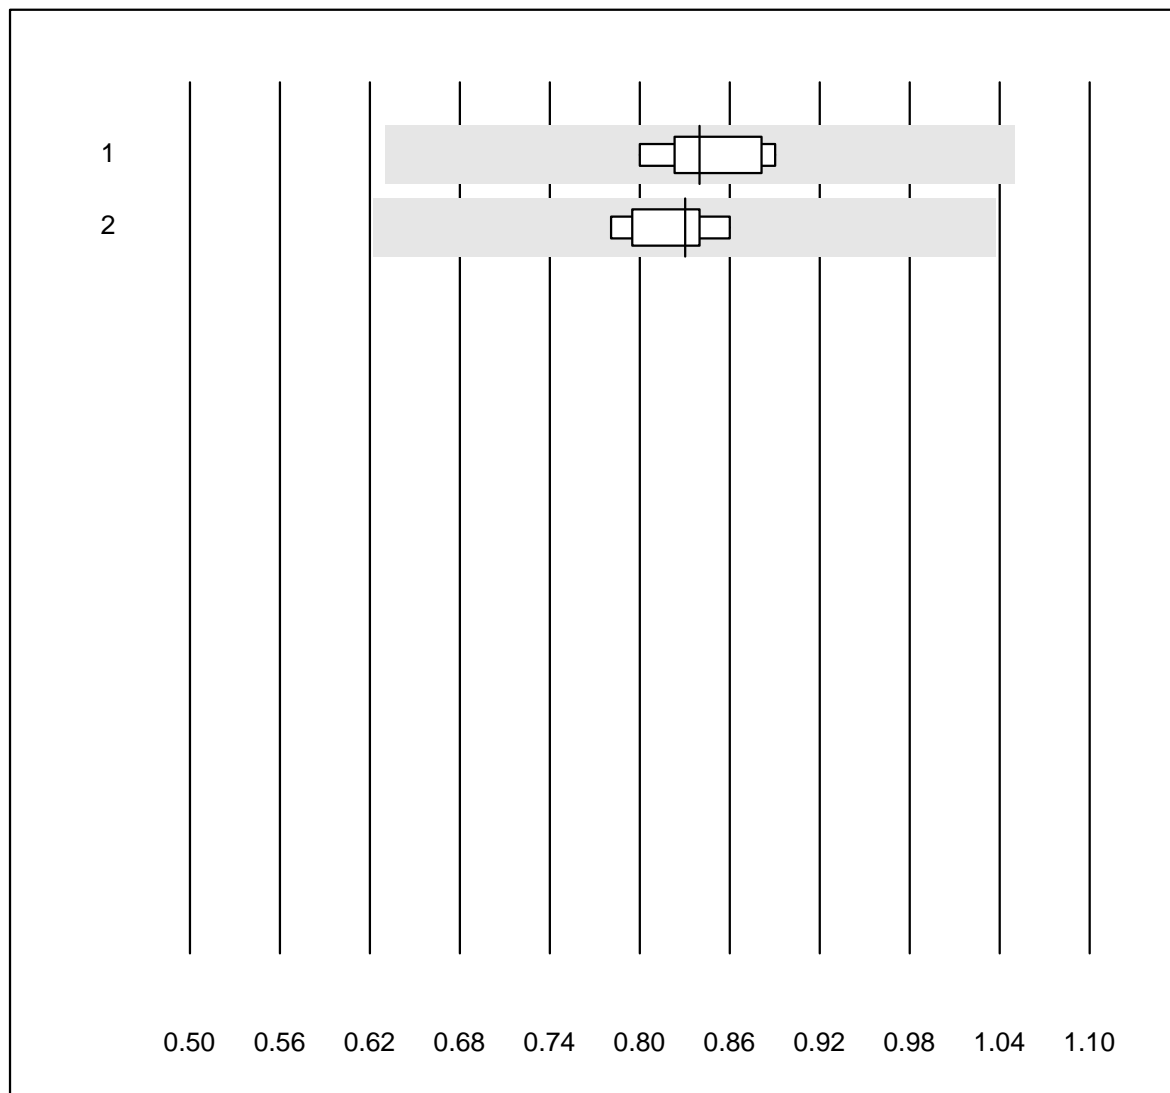


QUALAB Tolérance : 25 %

PSA frei (µg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas E / Elecsys	9	100.0	0.0	0.0	0.84	3.7	e
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	0.83	4.0	e

CEA

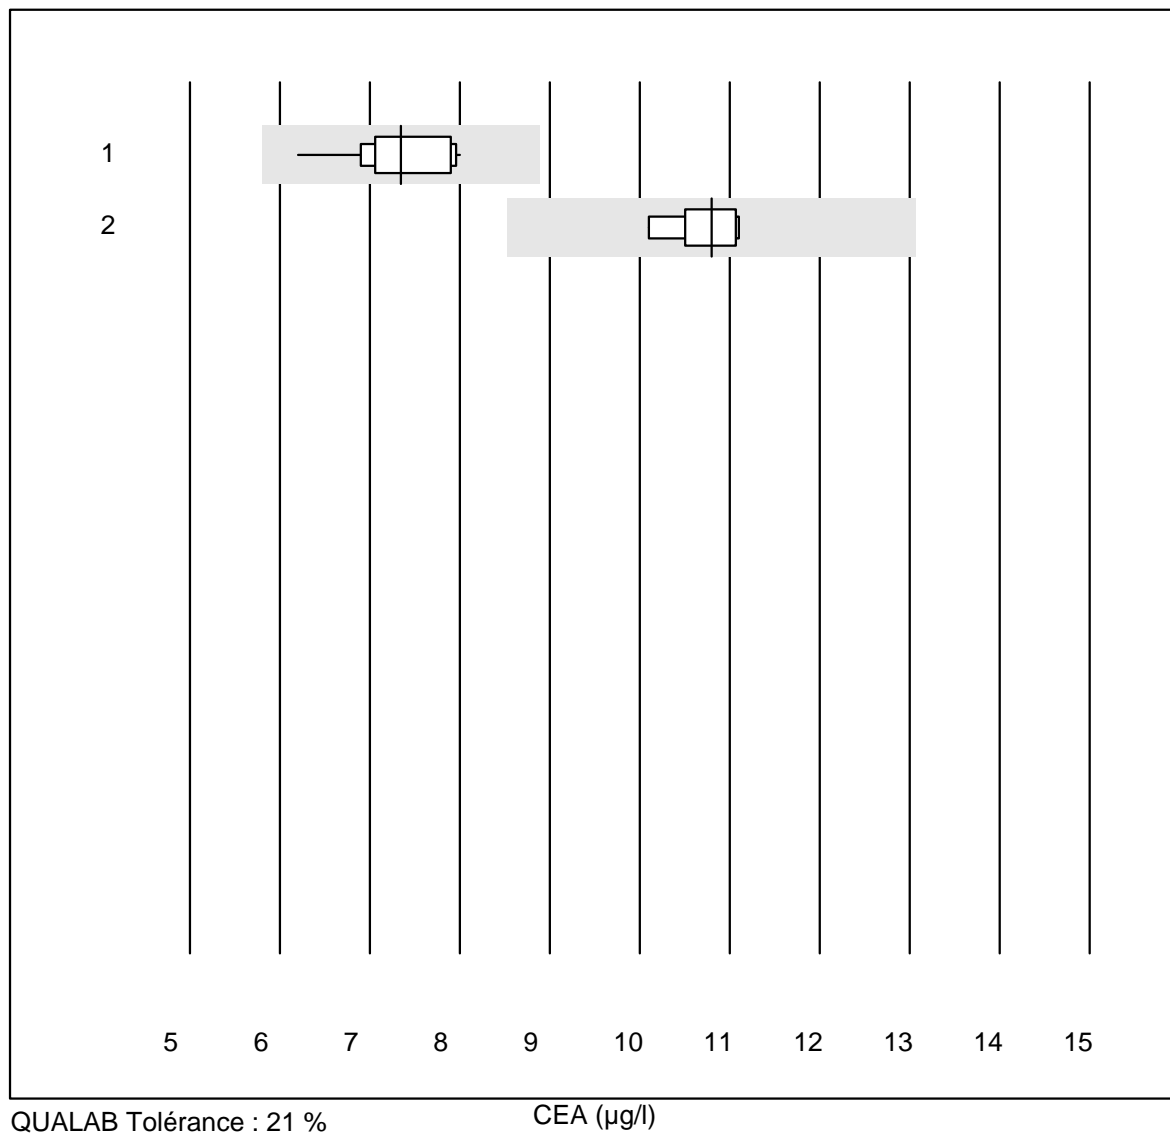


QUALAB Tolérance : 21 %

CEA (µg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas E / Elecsys	11	100.0	0.0	0.0	7.3	7.7	e
2 Architect	6	100.0	0.0	0.0	10.8	3.5	e

CA 125

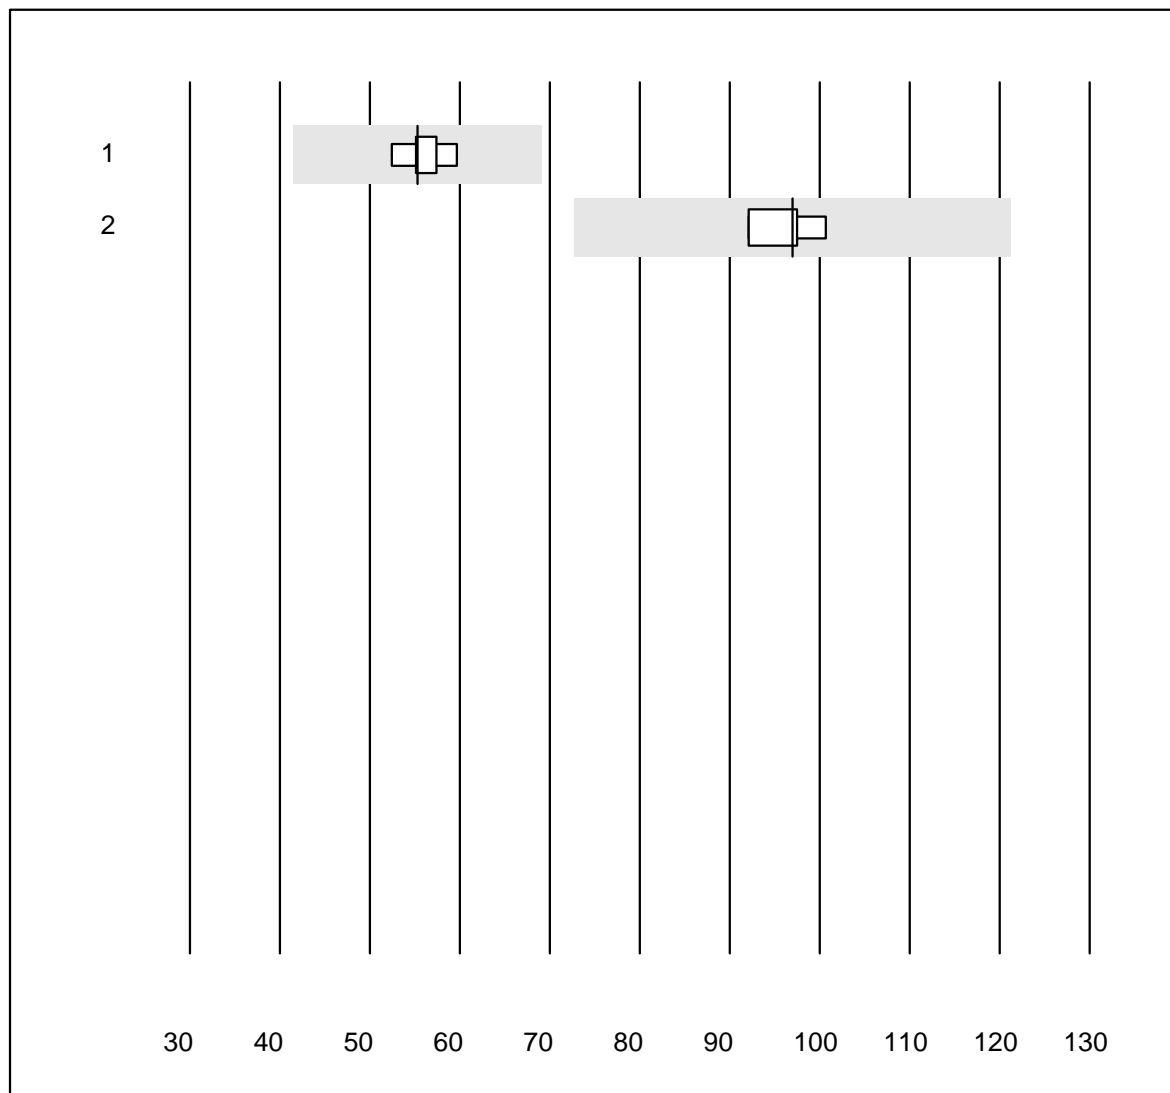


Tolérance MQ : 25 %

CA 125 (kIU/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas E / Elecsys	6	100.0	0.0	0.0	55.3	4.4	e
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	97.0	3.7	e

CA 19-9

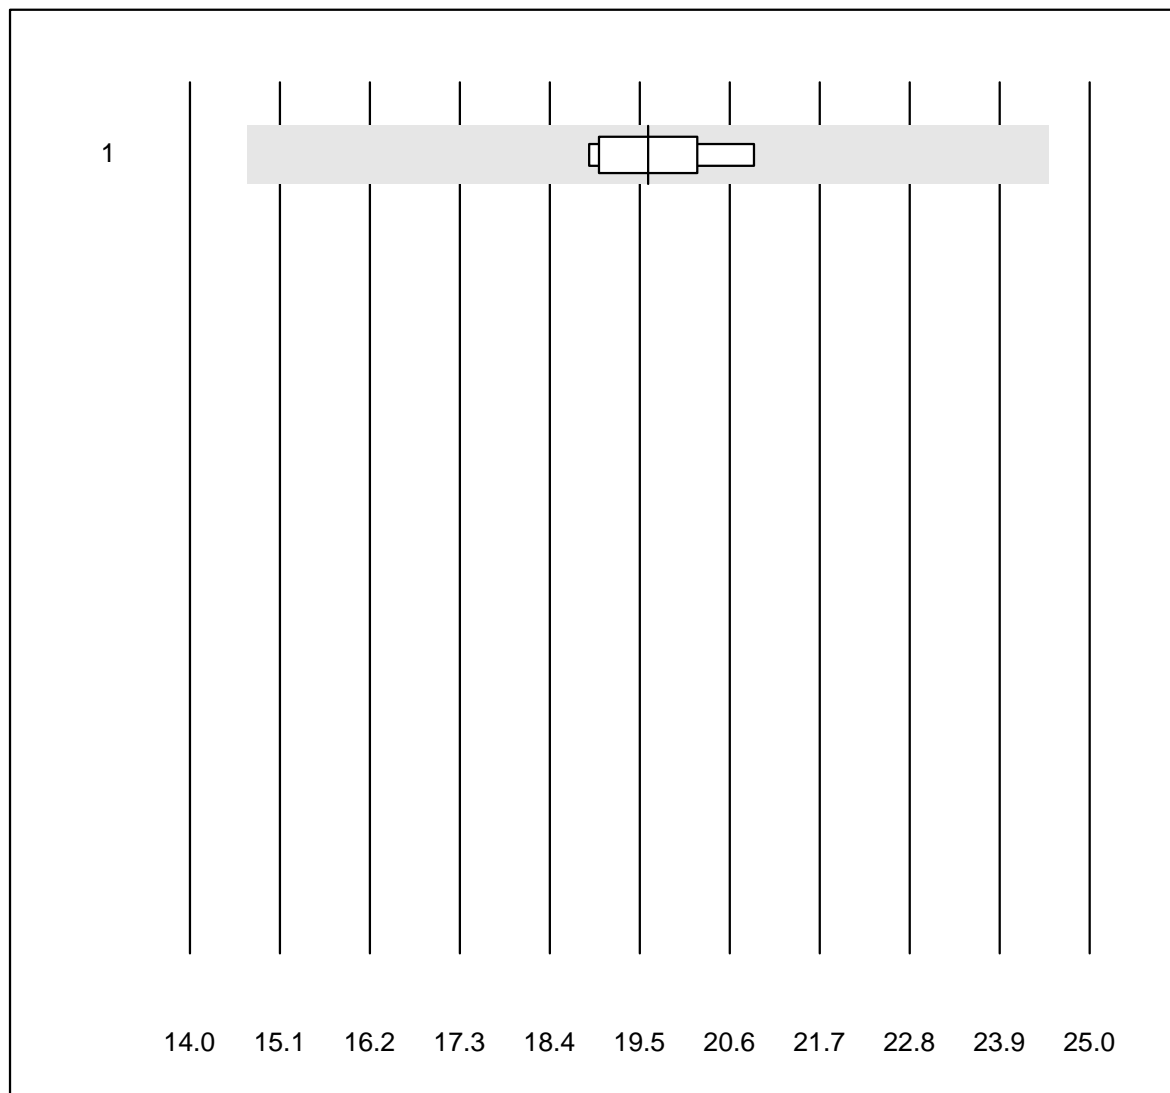


Tolérance MQ : 25 %

CA 19-9 (kIU/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas E / Elecsys	6	100.0	0.0	0.0	19.6	4.0	e

CA 15-3

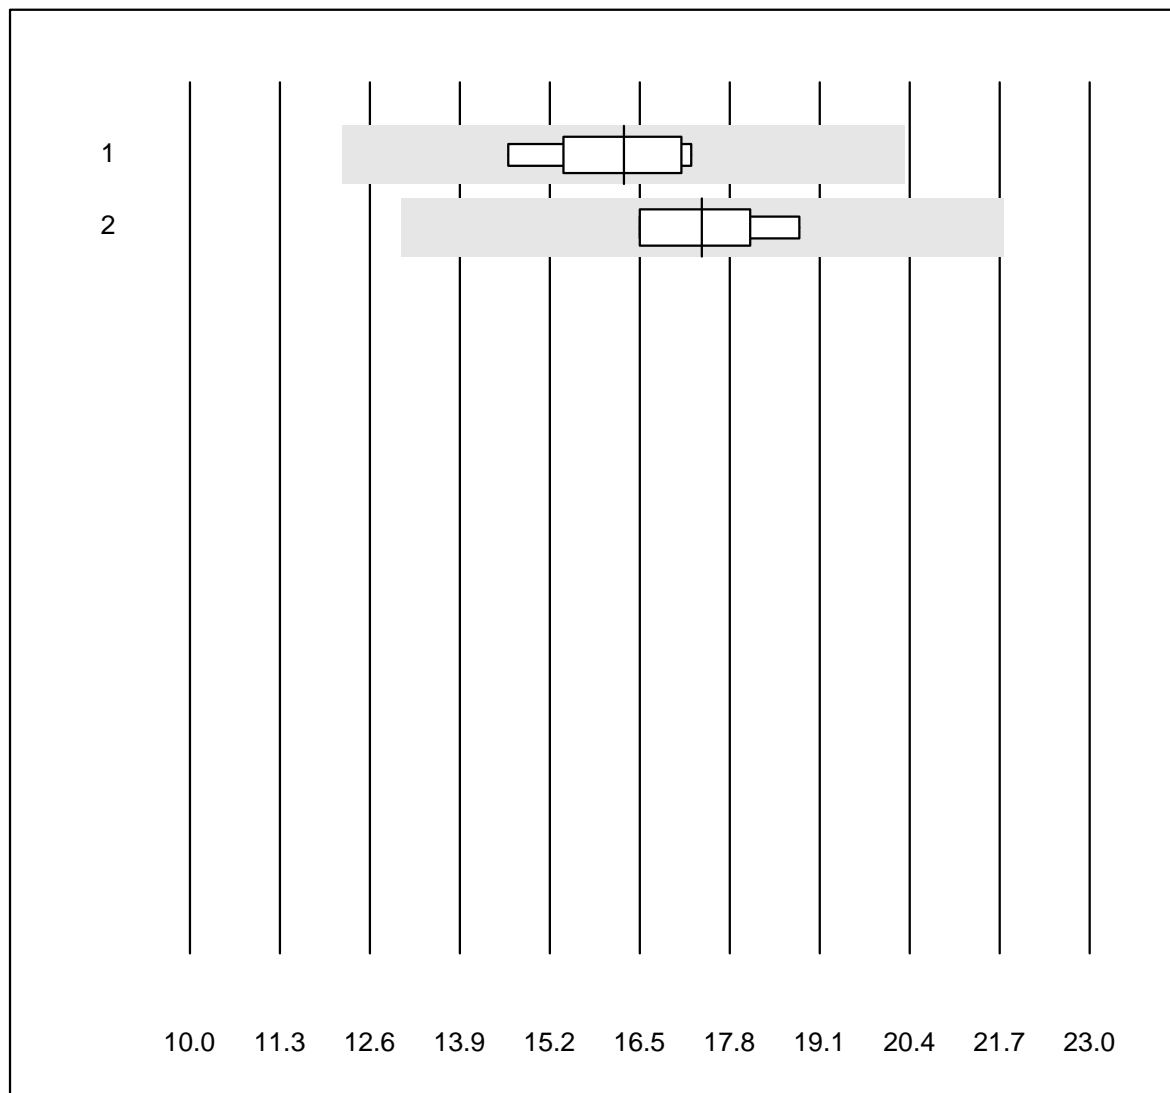


Tolérance MQ : 25 %

CA 15-3 (kIU/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas E / Elecsys	7	100.0	0.0	0.0	16.3	6.3	a
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	17.4	6.3	e*

AFP

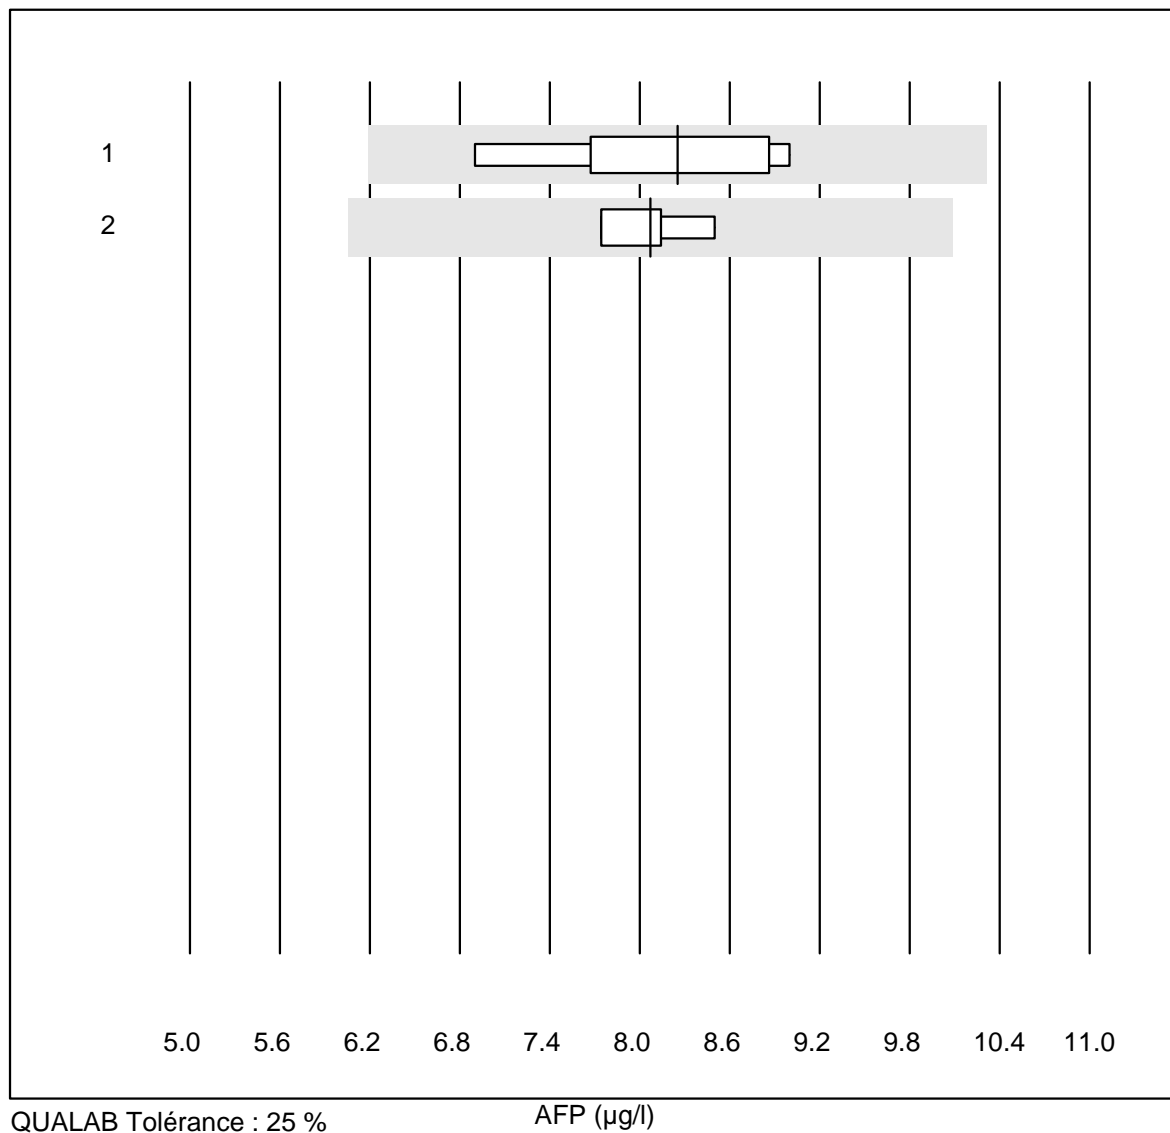


QUALAB Tolérance : 25 %

AFP (µg/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas E / Elecsys	6	100.0	0.0	0.0	8.3	9.8	e*
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	8.1	3.9	e

HCG qn

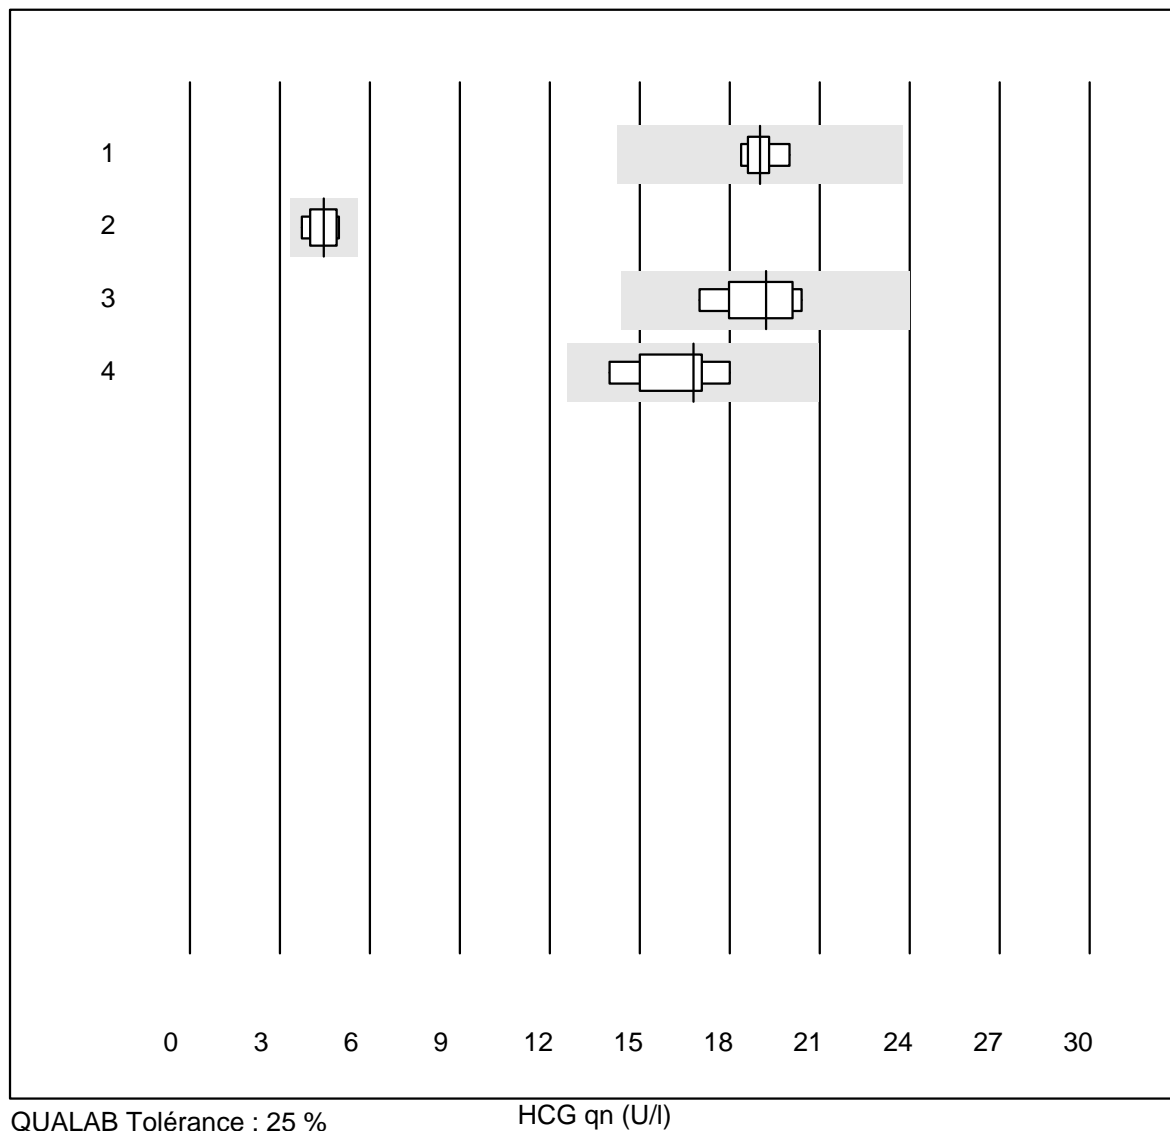

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas E / Elecsys	8	100.0	0.0	0.0	19.0	2.7	a
2 VIDAS	7	100.0	0.0	0.0	4.5	11.1	e*
3 Architect	7	85.7	0.0	14.3	19.2	6.8	e
4 AFIAS	8	100.0	0.0	0.0	16.8	9.0	e*

Thyreoglobuline

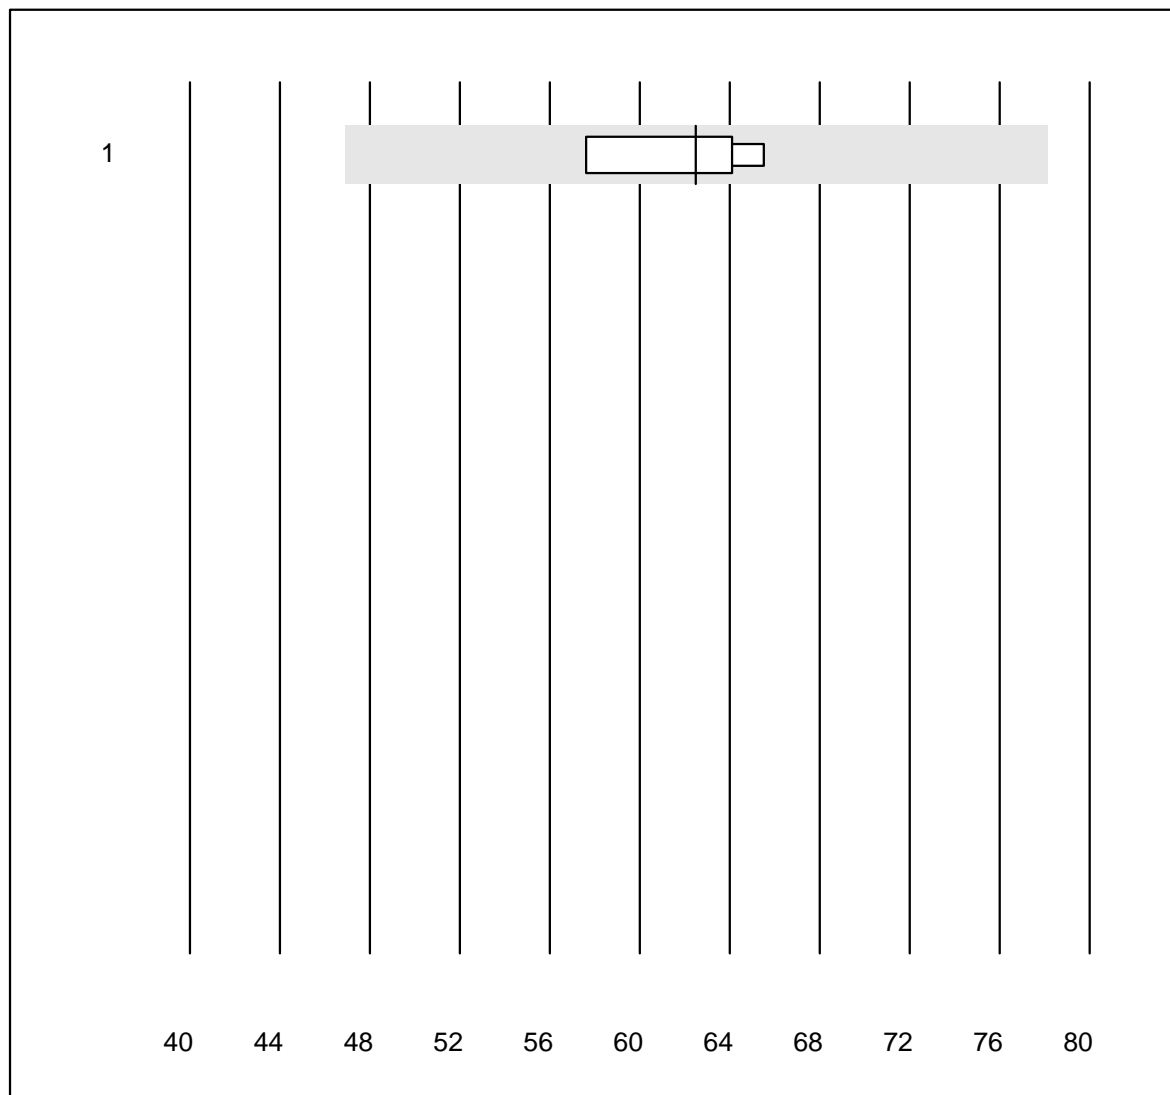


Tolérance MQ : 25 %

Thyreoglobuline (µg/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	62.5	5.7	e

CK-MB

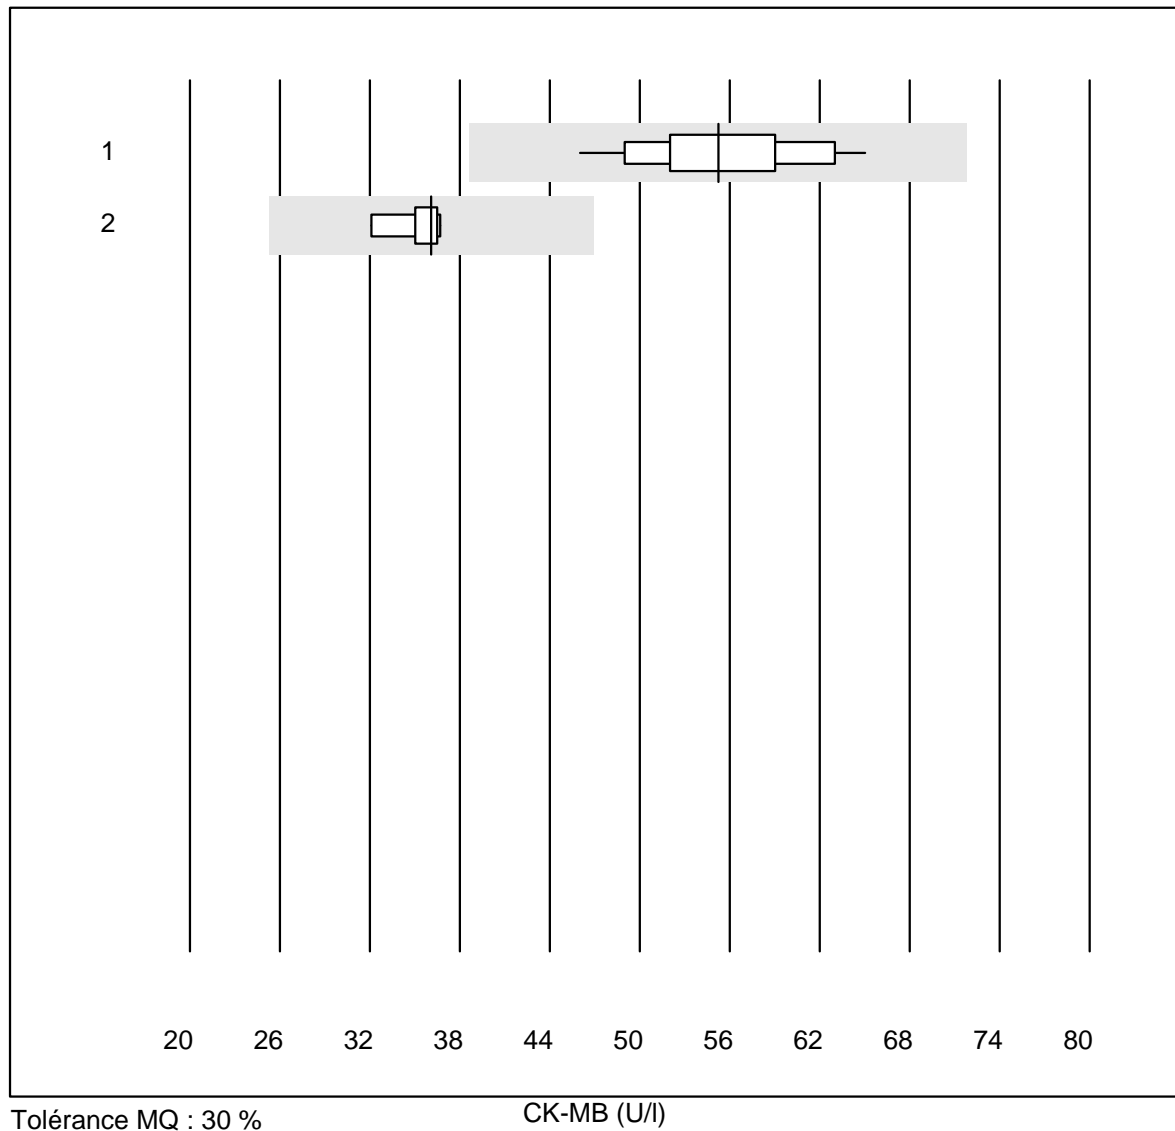

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Fuji Dri-Chem	28	100.0	0.0	0.0	55.3	9.3	e
2 Cobas/Roche	6	100.0	0.0	0.0	36.1	4.9	e

BNP

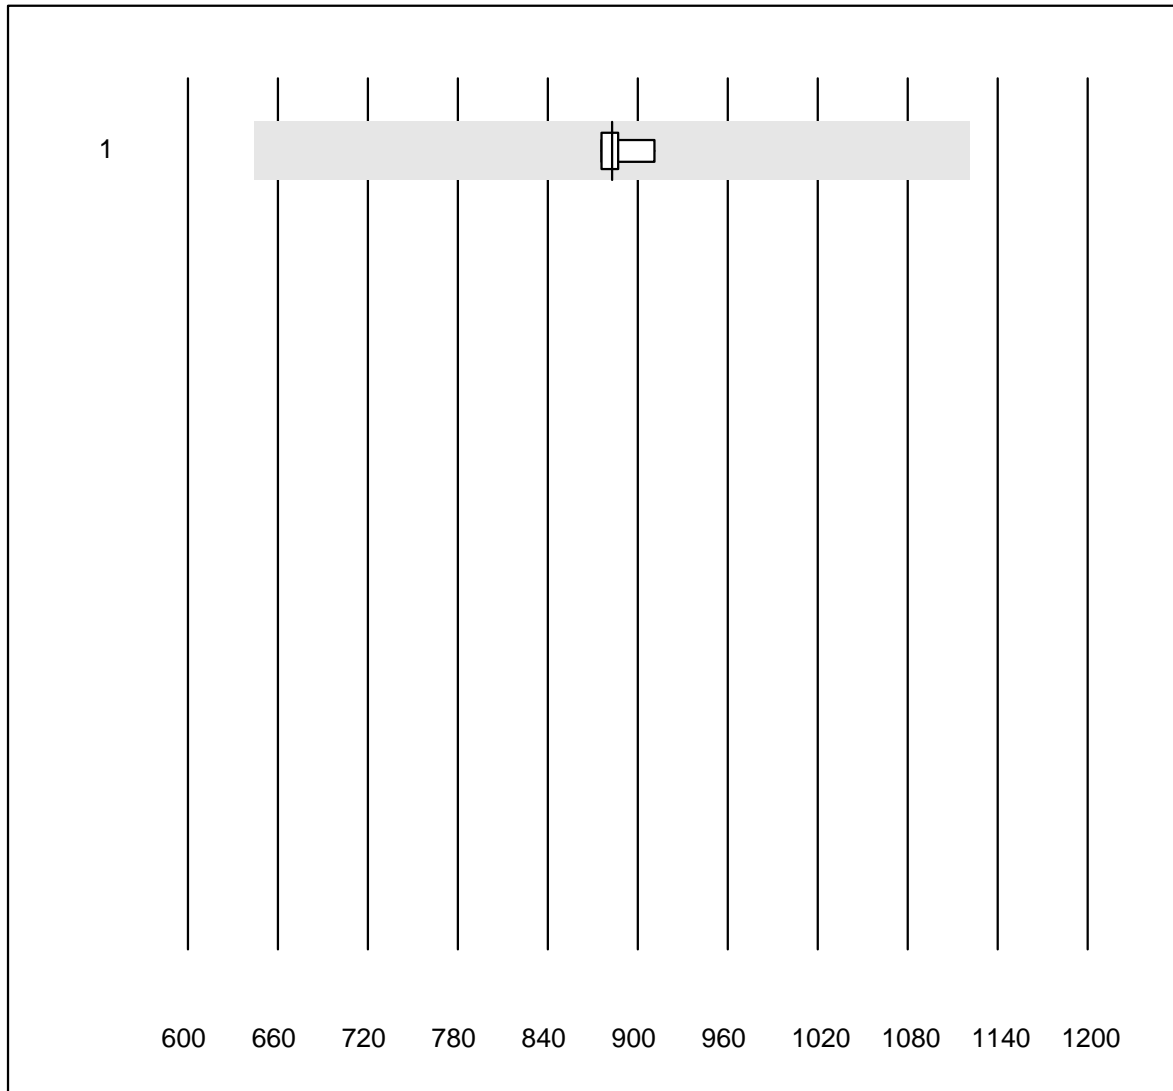


QUALAB Tolérance : 27 %

BNP (ng/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Architect	4	100.0	0.0	0.0	882.8	1.8	e

Cholestérol PTS

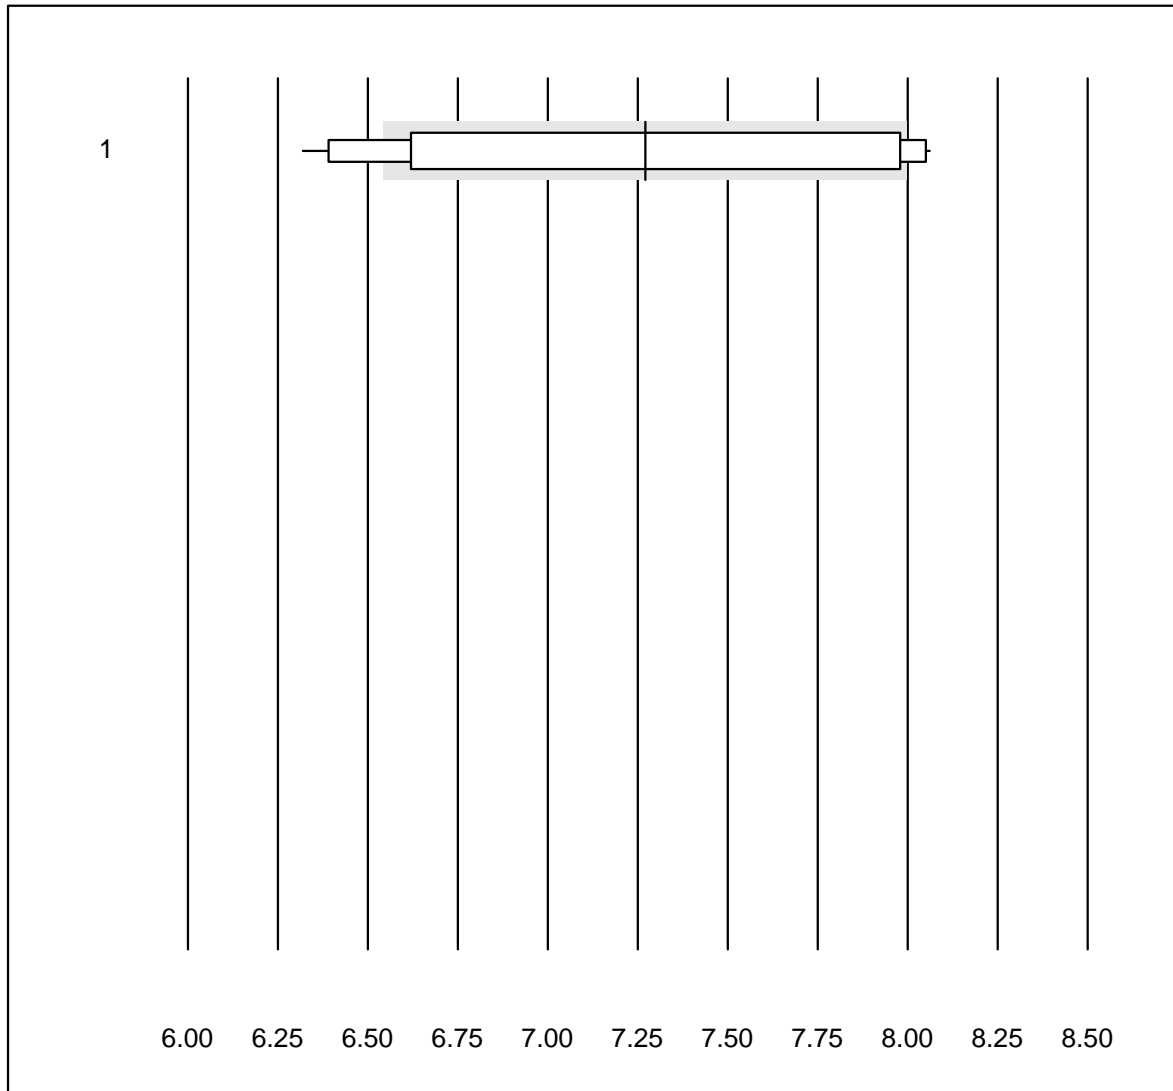


QUALAB Tolérance : 10 %

Cholestérol PTS (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 CardioChek	13	53.8	38.5	7.7	7.27	9.4	e*

Cholestérol HDL PTS

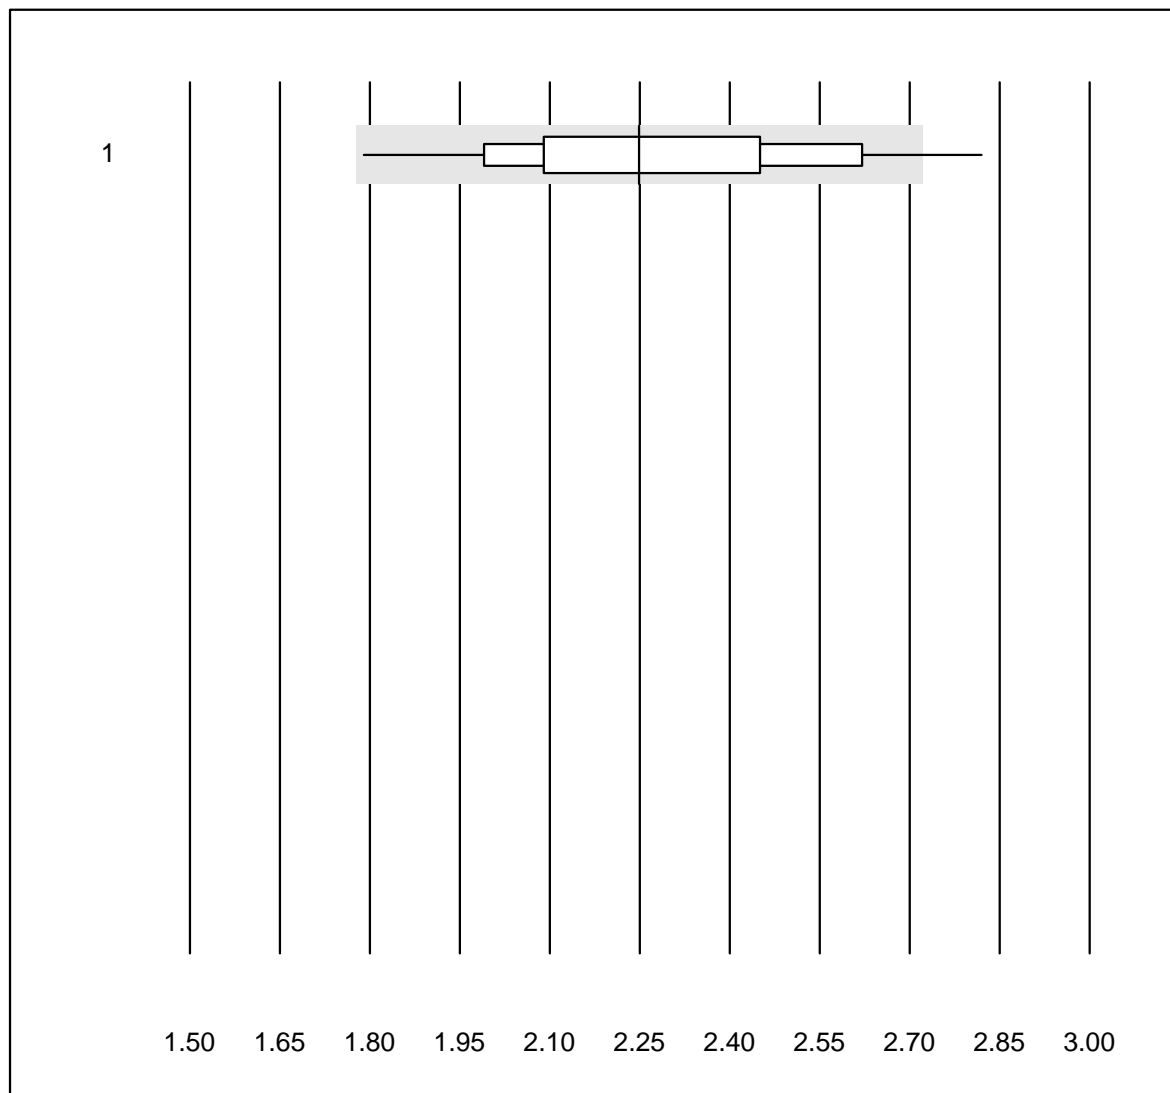


QUALAB Tolérance : 21 %

Cholestérol HDL PTS (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 CardioChek	13	92.3	7.7	0.0	2.25	12.5	e*

Triglycérides PTS

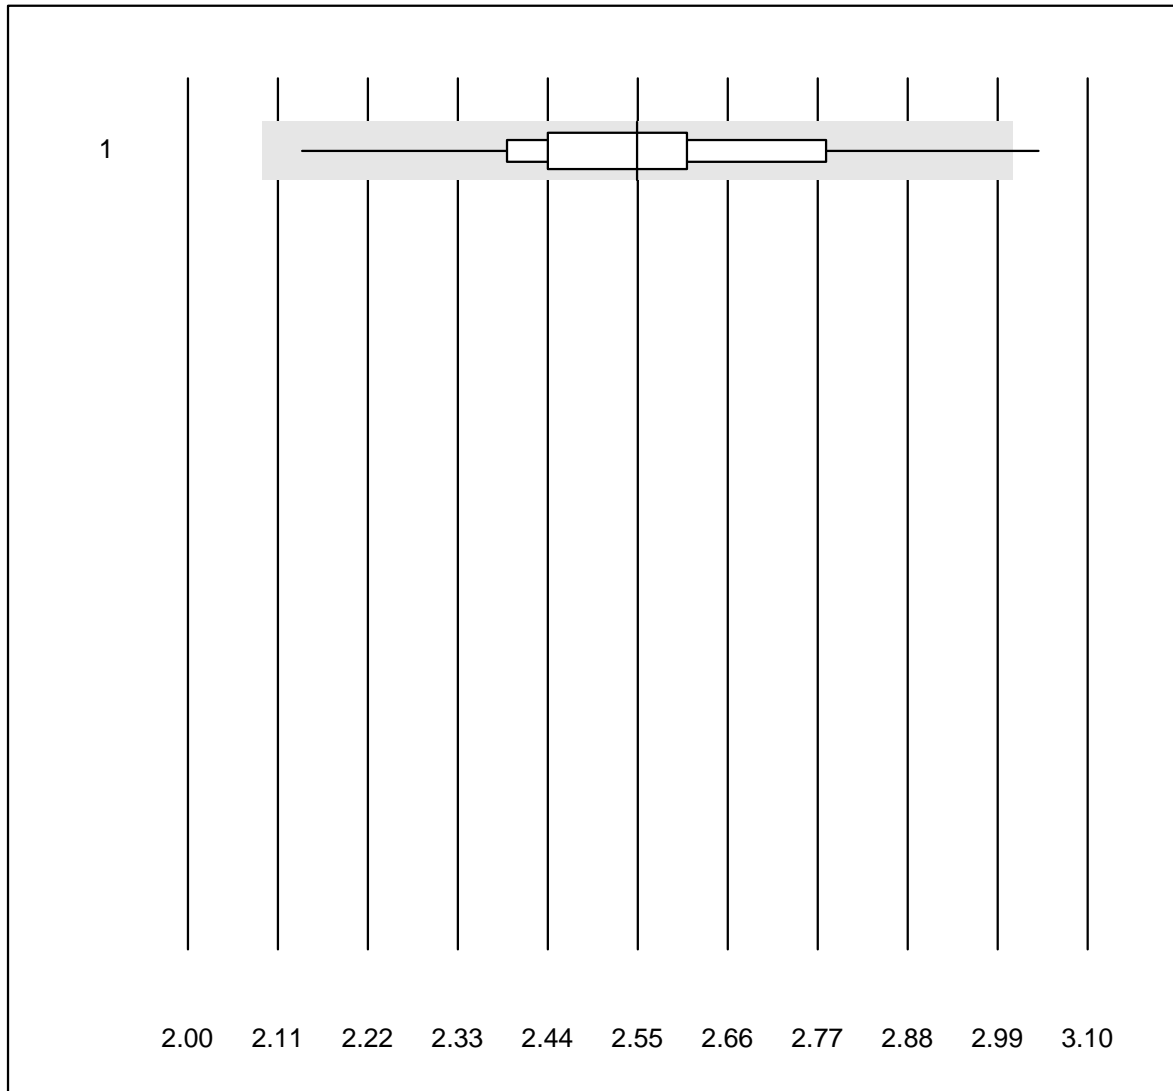


QUALAB Tolérance : 18 %

Triglycérides PTS (mmol/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 CardioChek	13	92.3	7.7	0.0	2.55	8.6	e*

C-Peptid

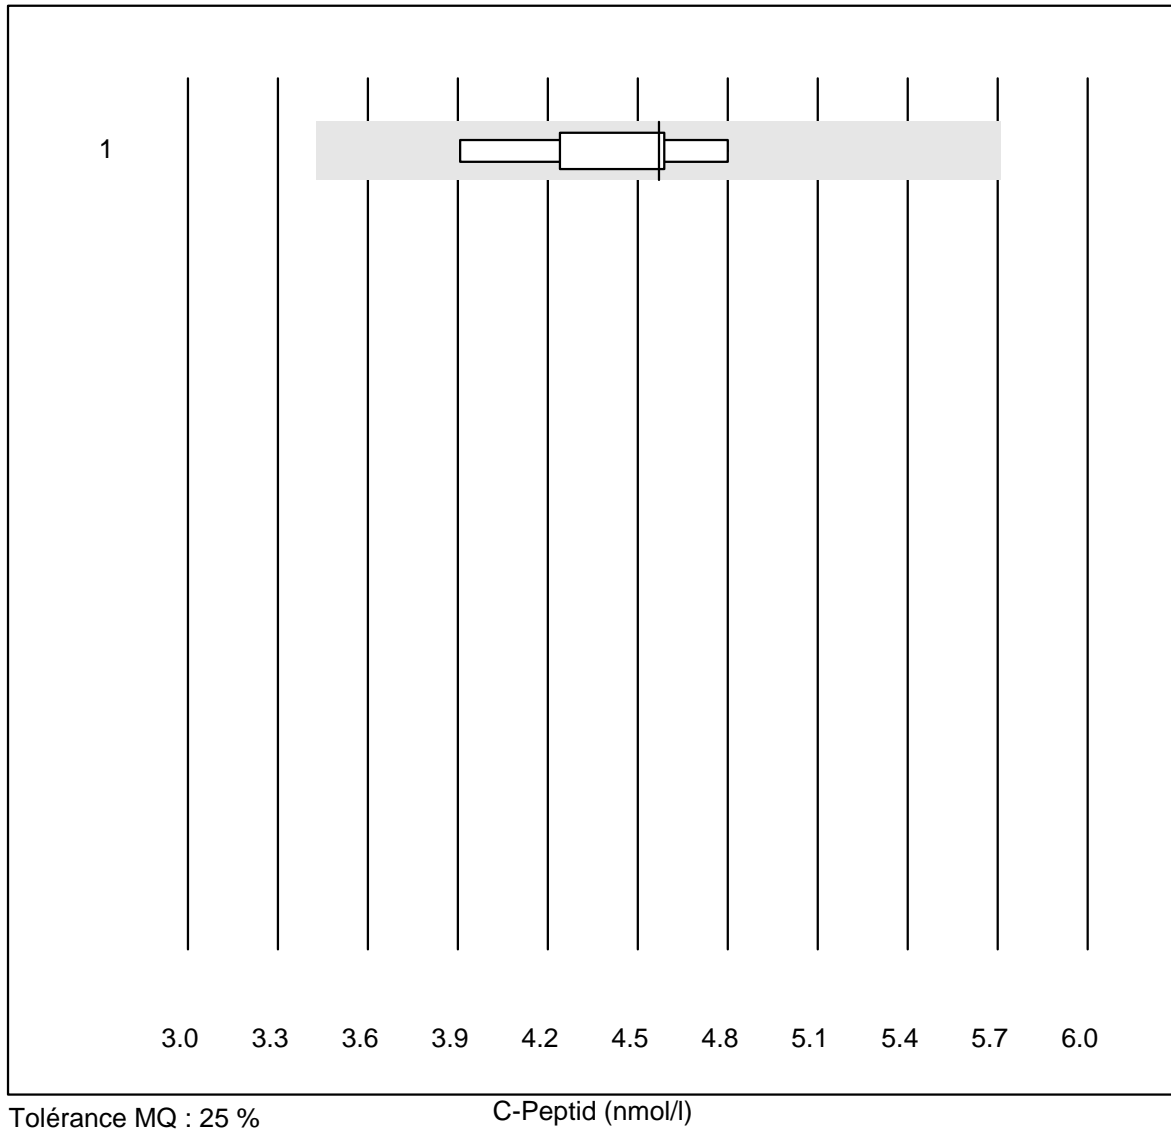

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	4.57	7.9	e*

Procalcitonine

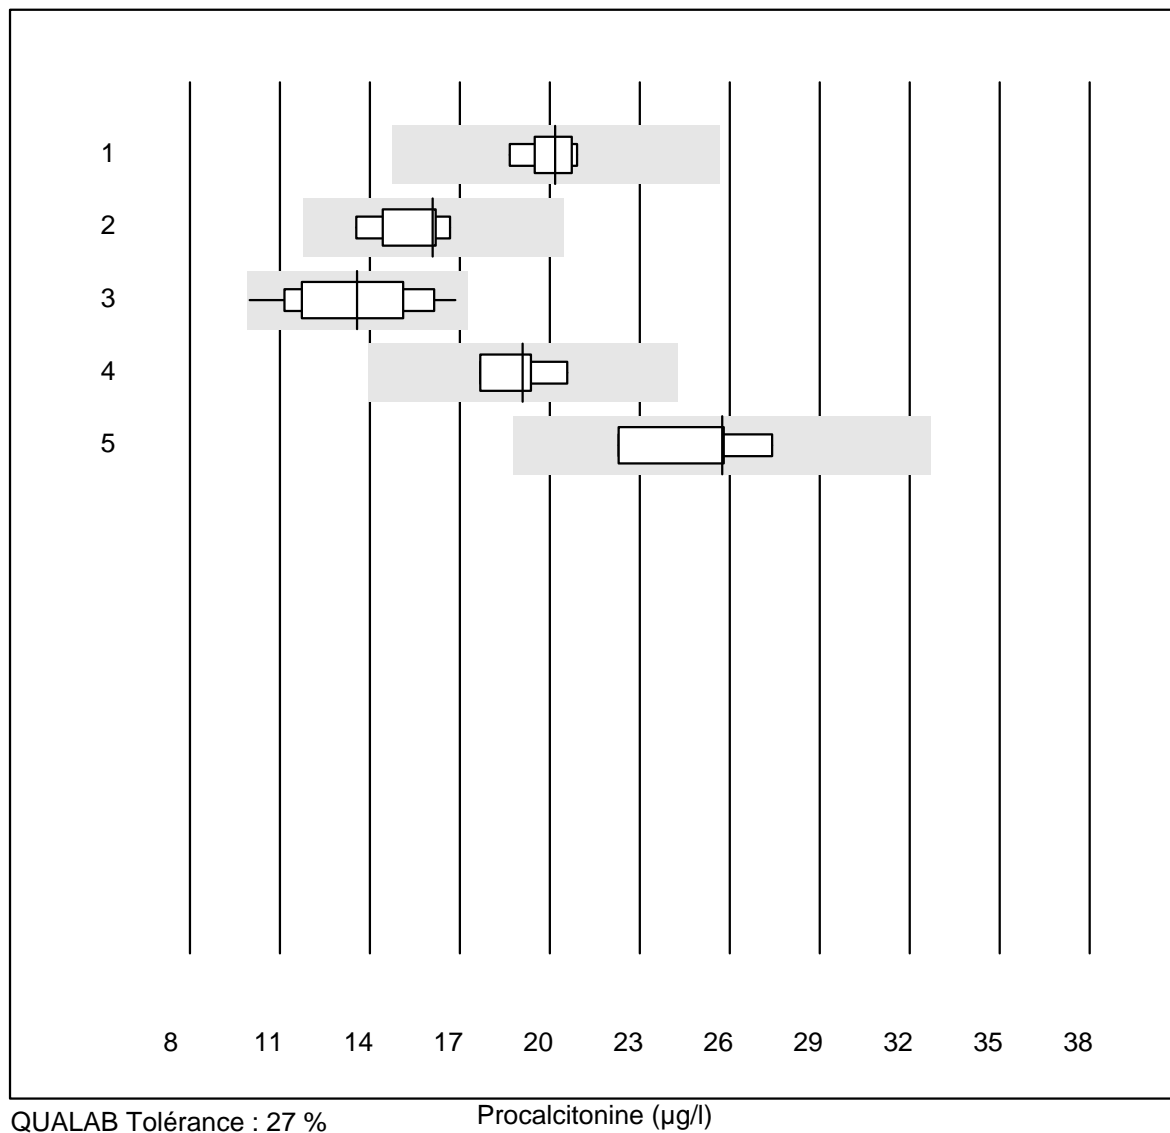


QUALAB Tolérance : 27 %

Procalcitonine (µg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Architect	6	100.0	0.0	0.0	20.19	4.2	e
2 Cobas	8	100.0	0.0	0.0	16.10	6.8	e
3 VIDAS	12	100.0	0.0	0.0	13.58	16.0	e*
4 ADVIA Centaur XP/CP	4	100.0	0.0	0.0	19.11	6.3	e
5 Liaison	4	100.0	0.0	0.0	25.75	8.5	e*

EPO

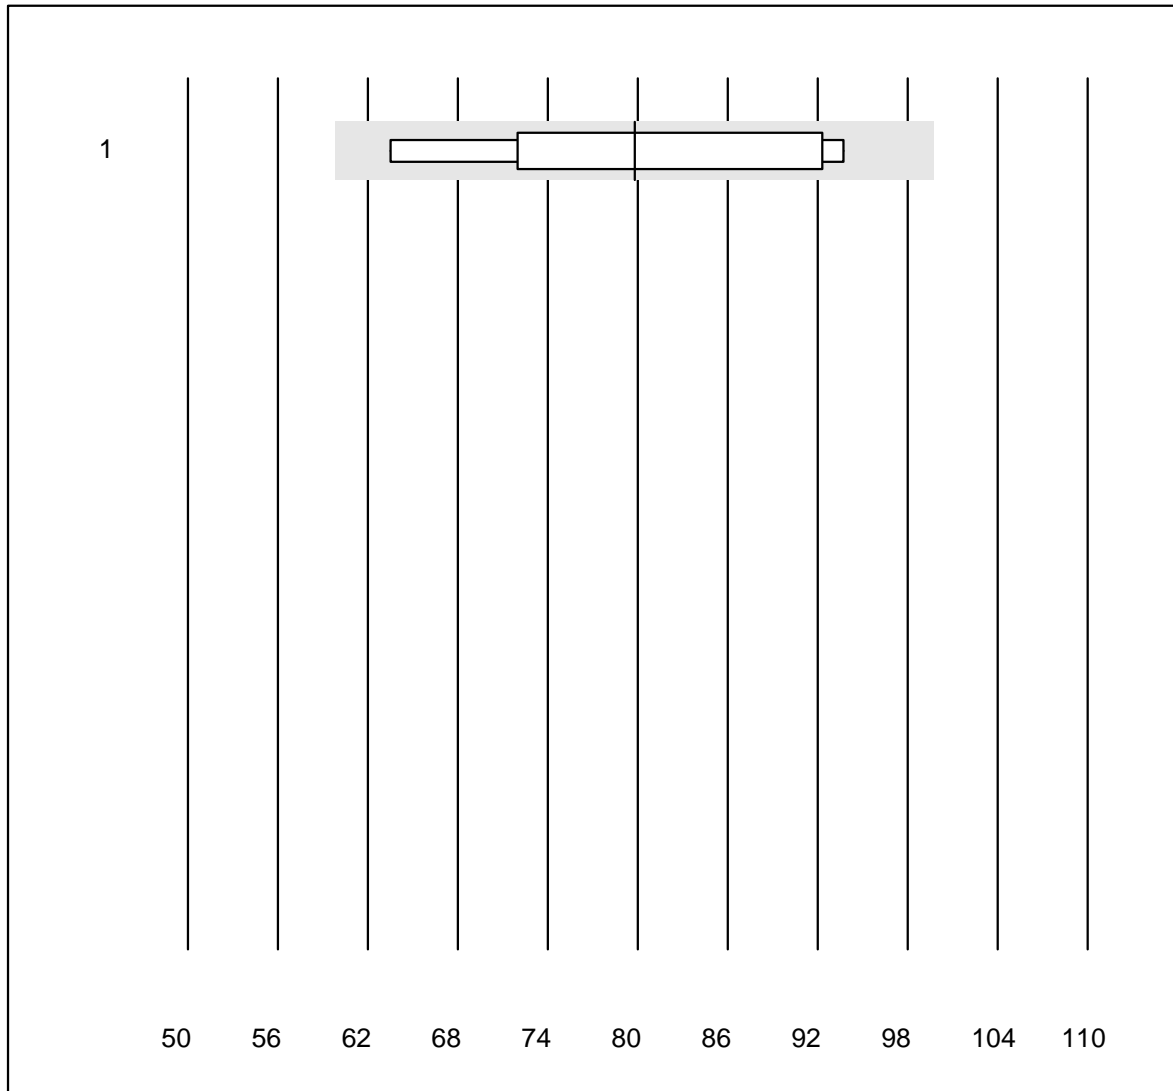


Tolérance MQ : 25 %

EPO (U/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Immulite	5	100.0	0.0	0.0	79.8	16.2	e*

Parathormone

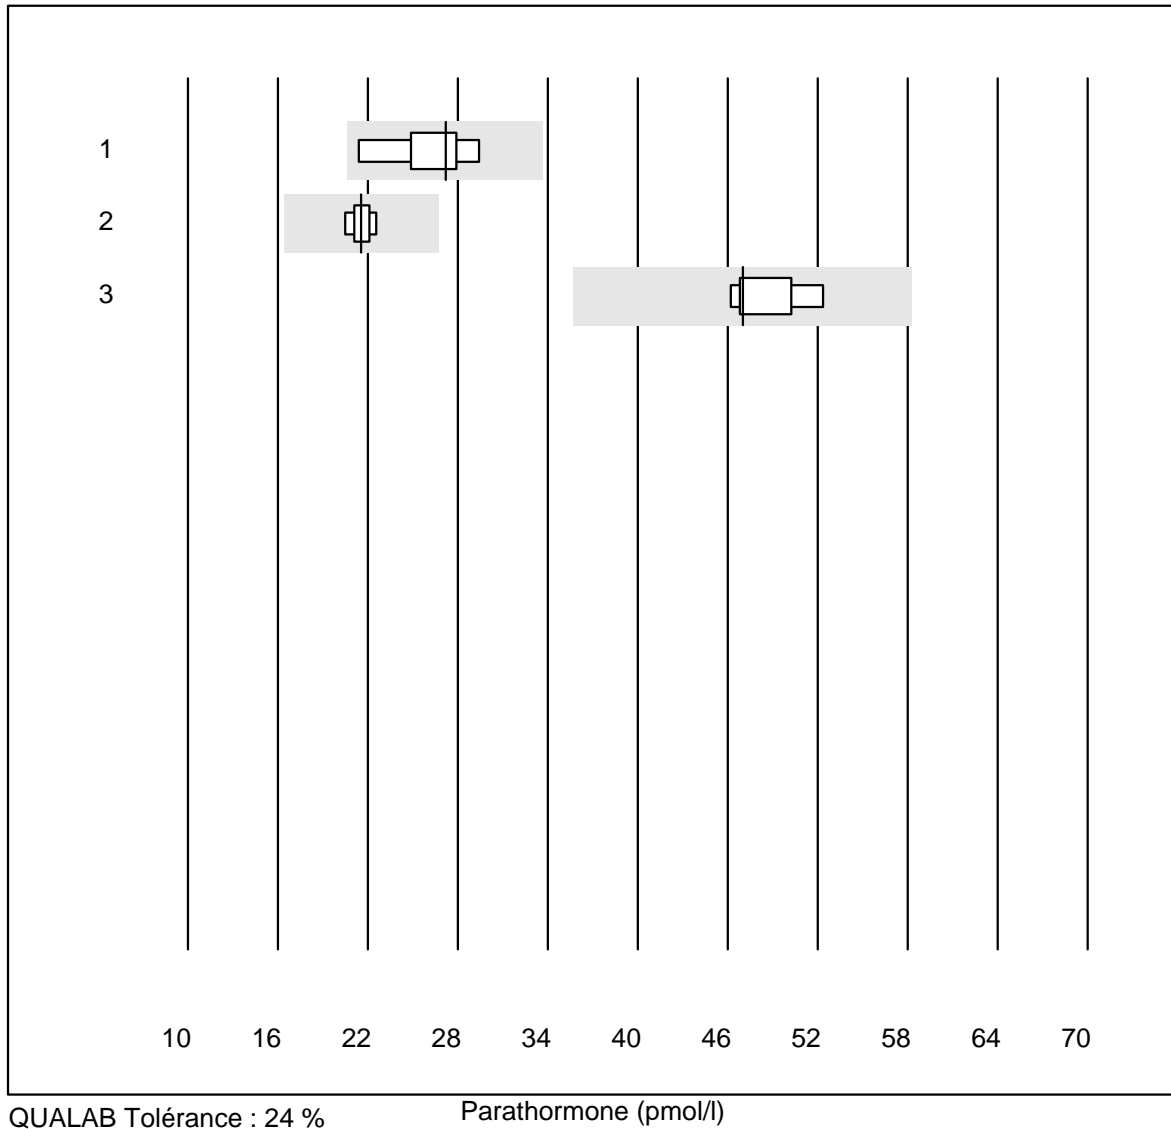

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas PTH STAT	8	100.0	0.0	0.0	27.2	9.3	e*
2 Cobas	6	100.0	0.0	0.0	21.6	3.5	e
3 Architect	5	100.0	0.0	0.0	47.0	5.5	e

Osmolalité

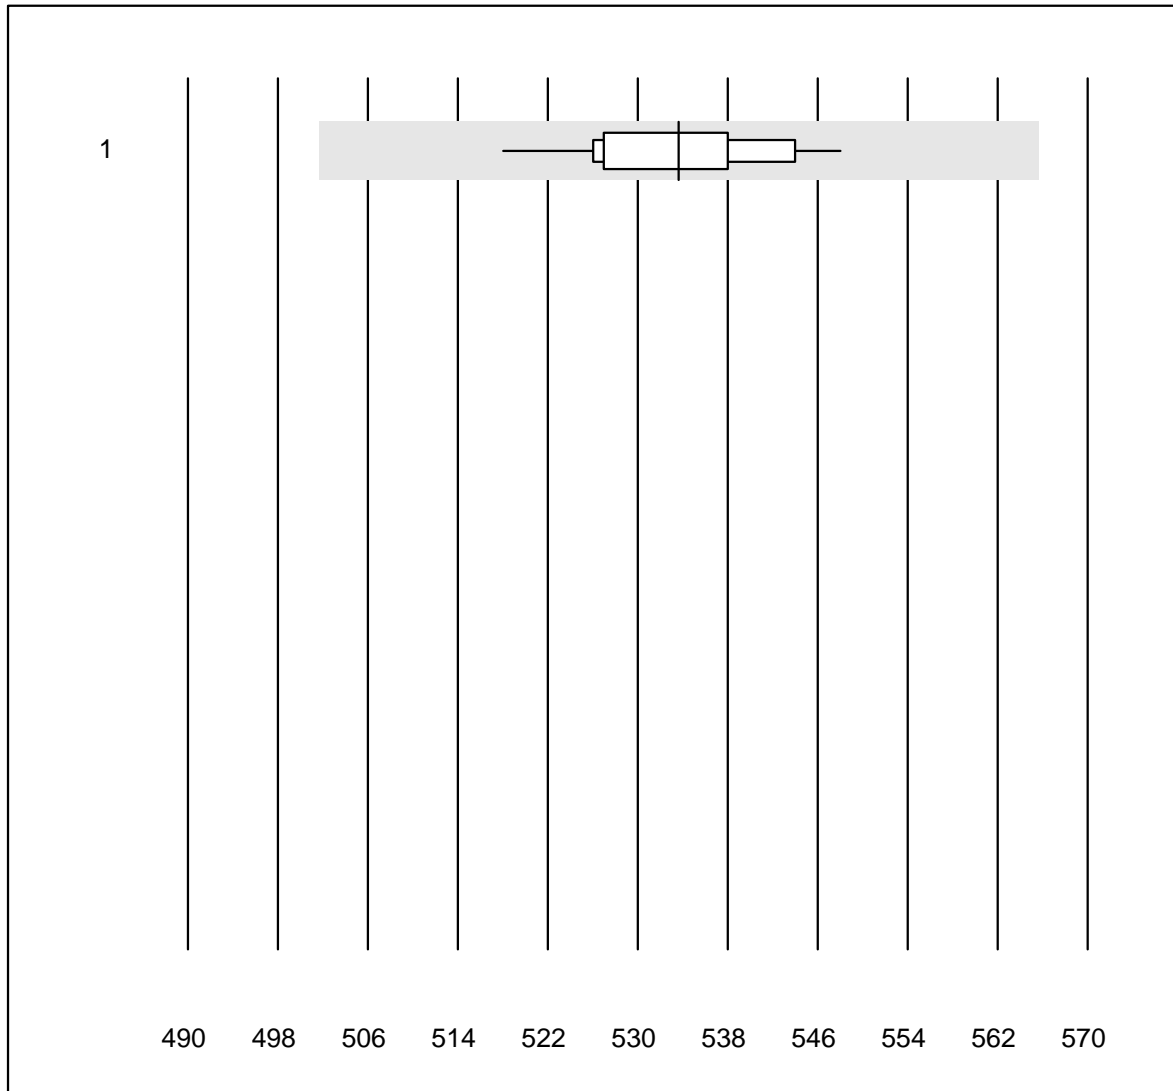


QUALAB Tolérance : 6 %

Osmolalité (mosm/kg)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cryoscopie	16	100.0	0.0	0.0	534	1.4	e

Kalium-K22

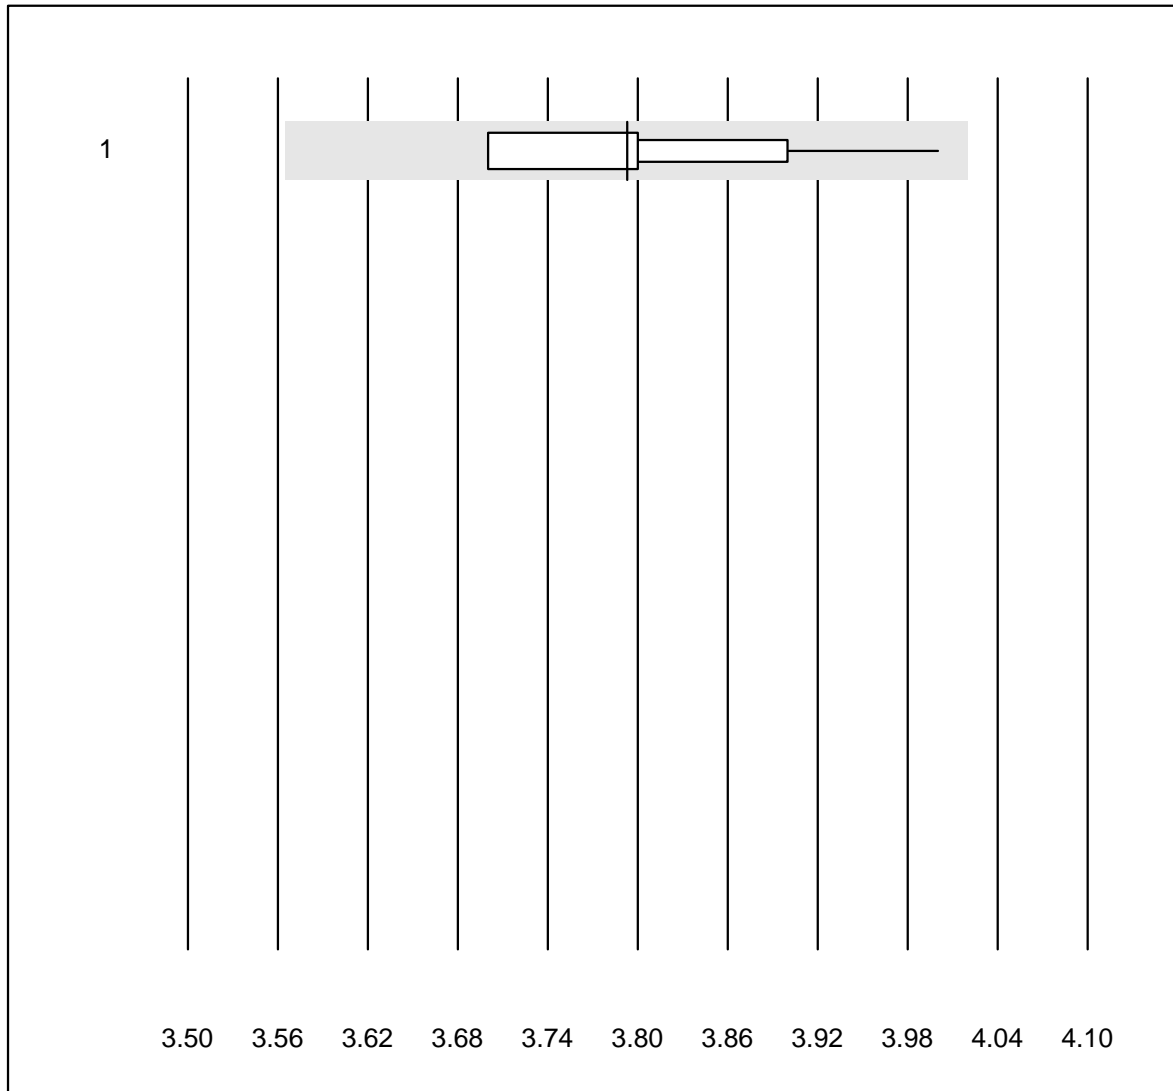


QUALAB Tolérance : 6 %

Kalium-K22 (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 ISE	11	100.0	0.0	0.0	3.8	2.4	e

Natrium-K22

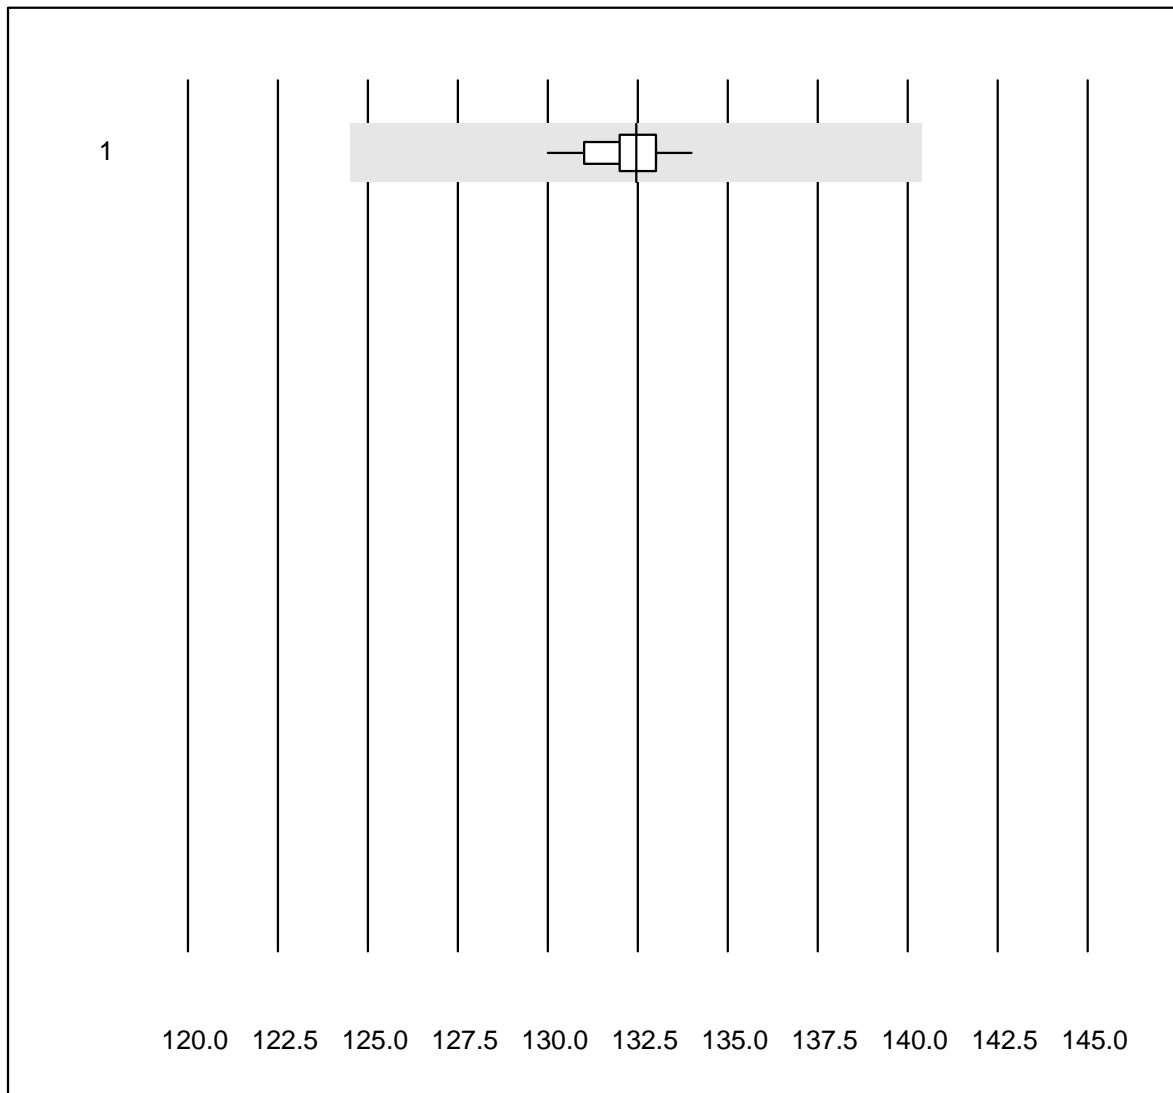


QUALAB Tolérance : 6 %

Natrium-K22 (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 ISE	11	100.0	0.0	0.0	132	0.9	e

Glukose-K22

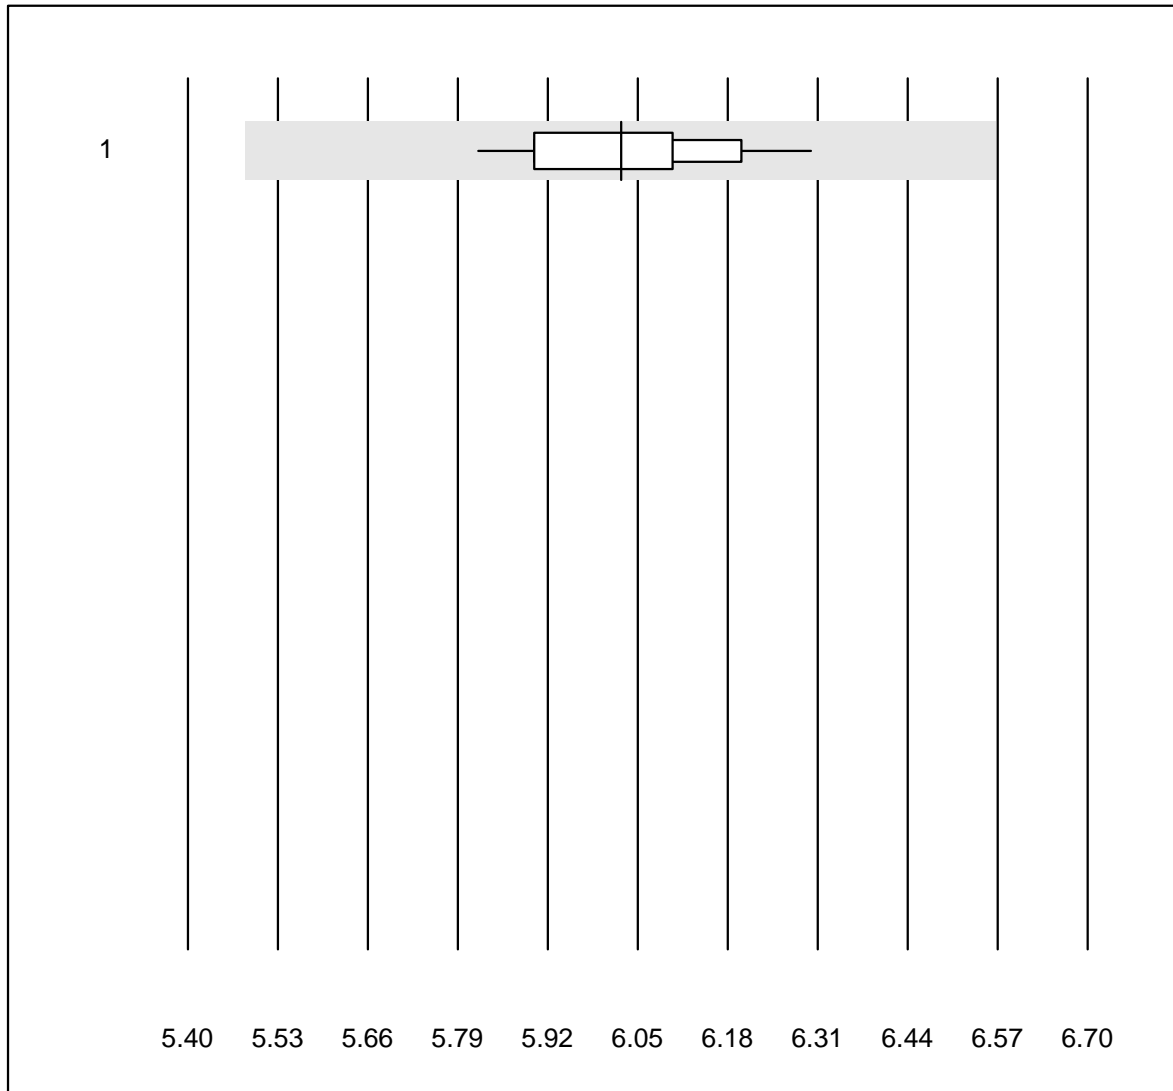


QUALAB Tolérance : 9 %

Glukose-K22 (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Chimie humide	11	100.0	0.0	0.0	6.0	2.3	e

Harnstoff-K22

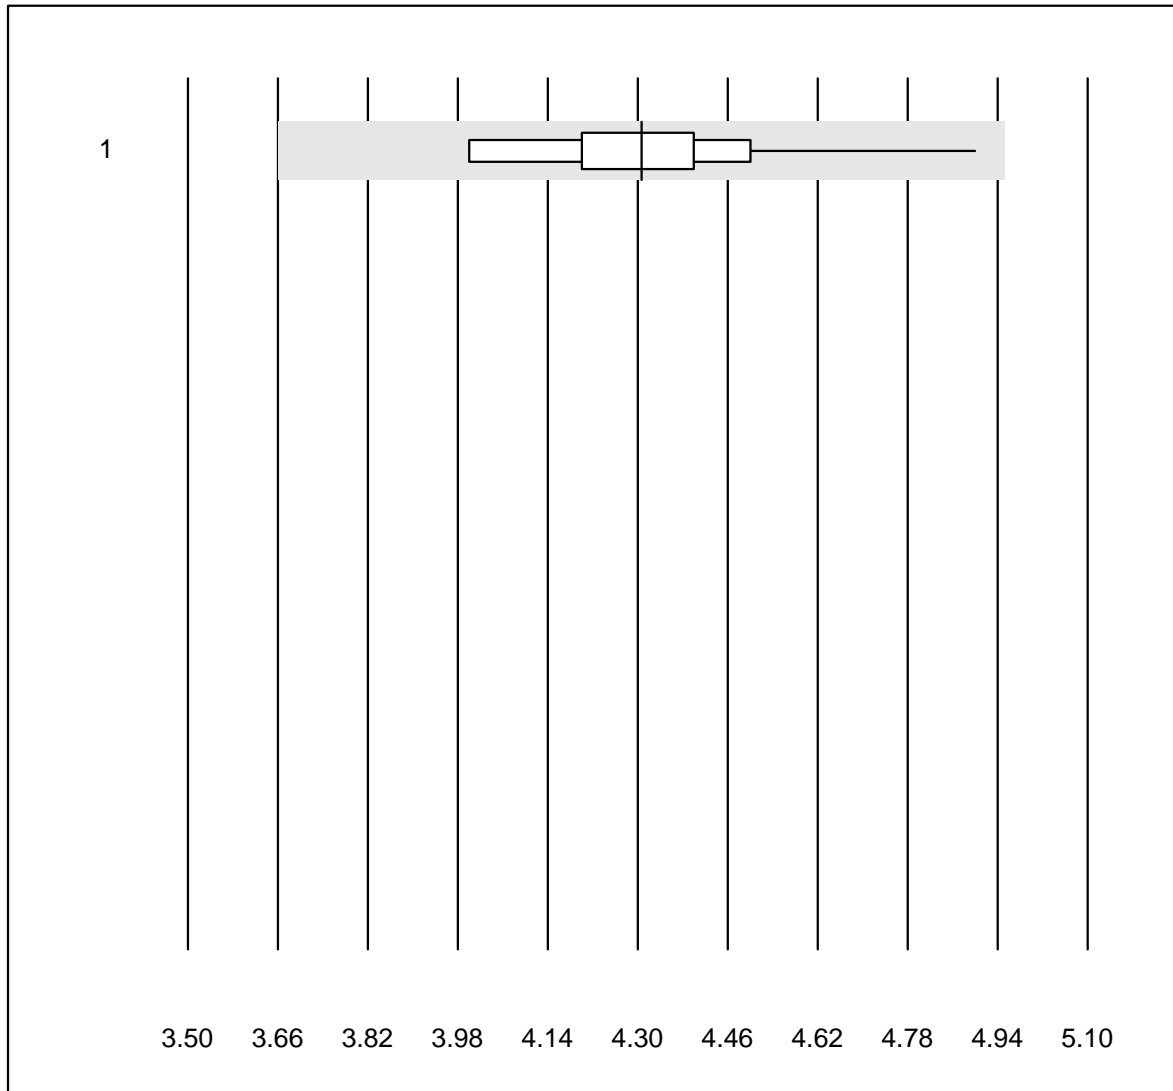


QUALAB Tolérance : 15 %

Harnstoff-K22 (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Chimie humide	11	100.0	0.0	0.0	4.3	5.7	e

Osmotische Lücke

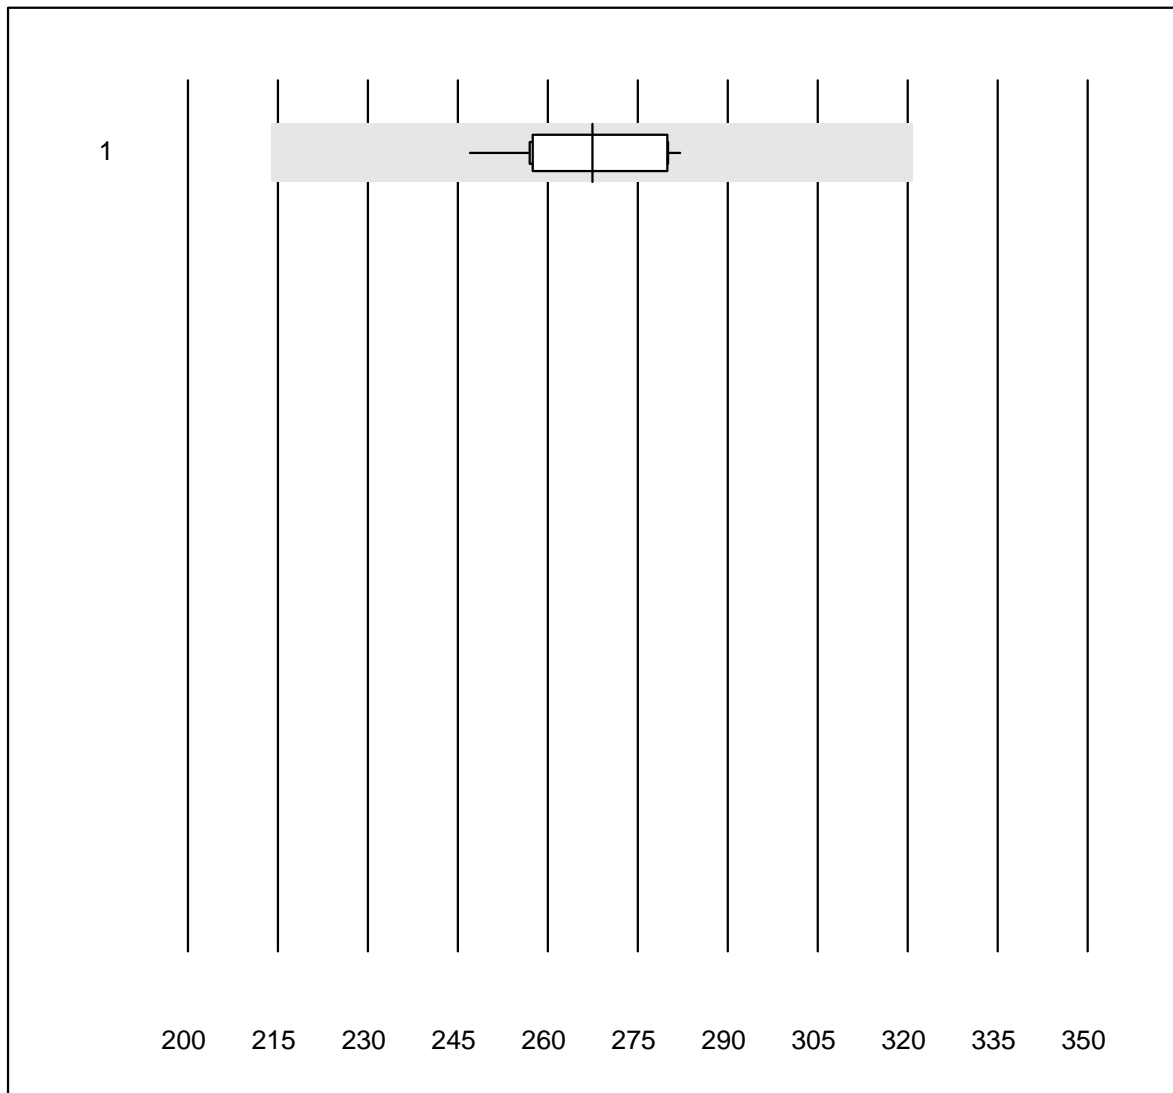


Tolérance MQ : 20 %

Osmotische Lücke (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Formel 1 (2Na+K+Glu+	11	100.0	0.0	0.0	267.4	4.4	e

Digoxin

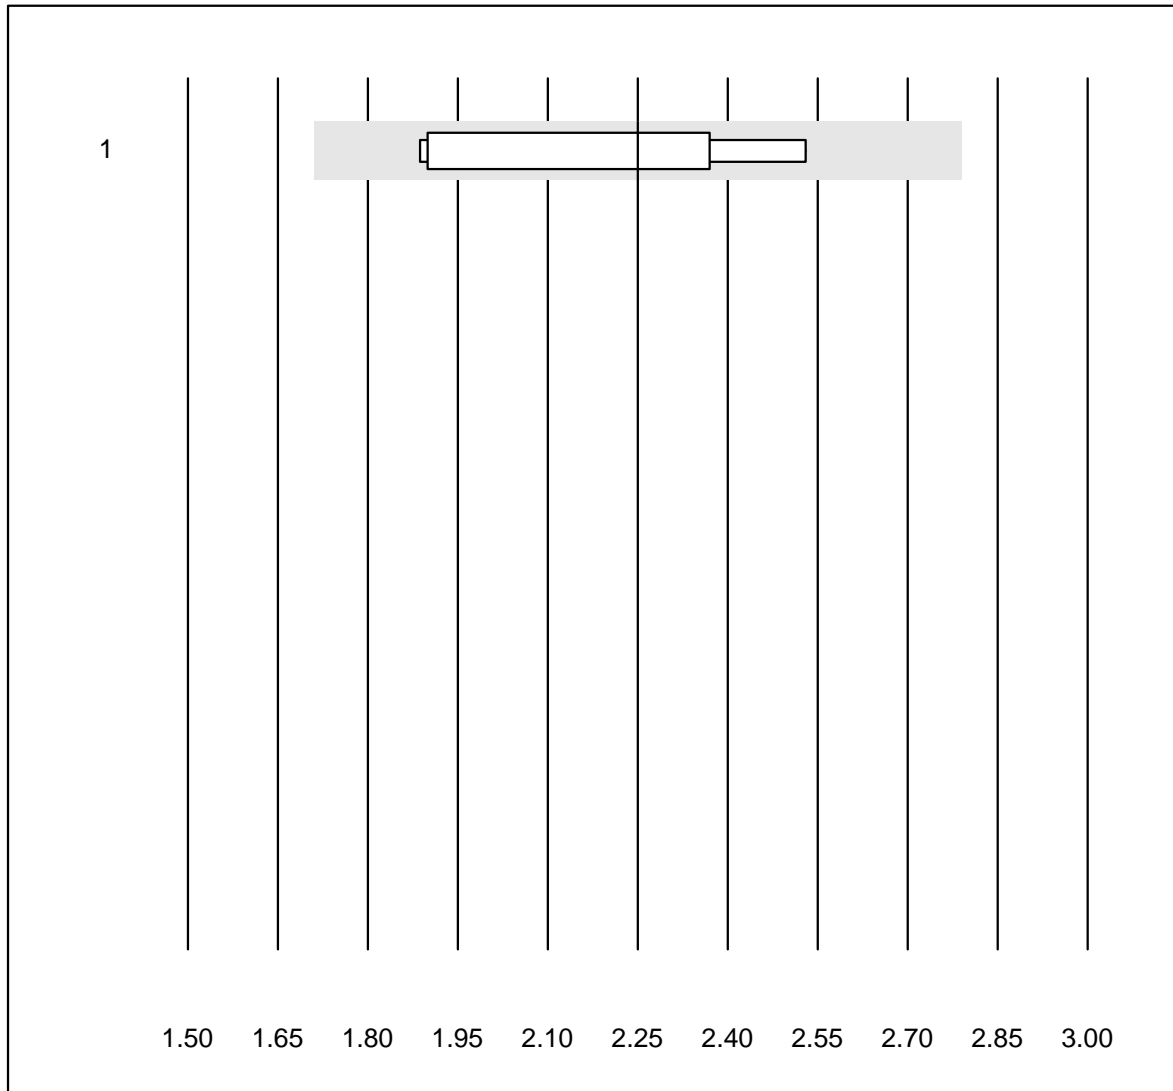


QUALAB Tolérance : 24 %

Digoxin (nmol/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Autres méthodes	6	100.0	0.0	0.0	2.25	11.8	e*

Paracetamol

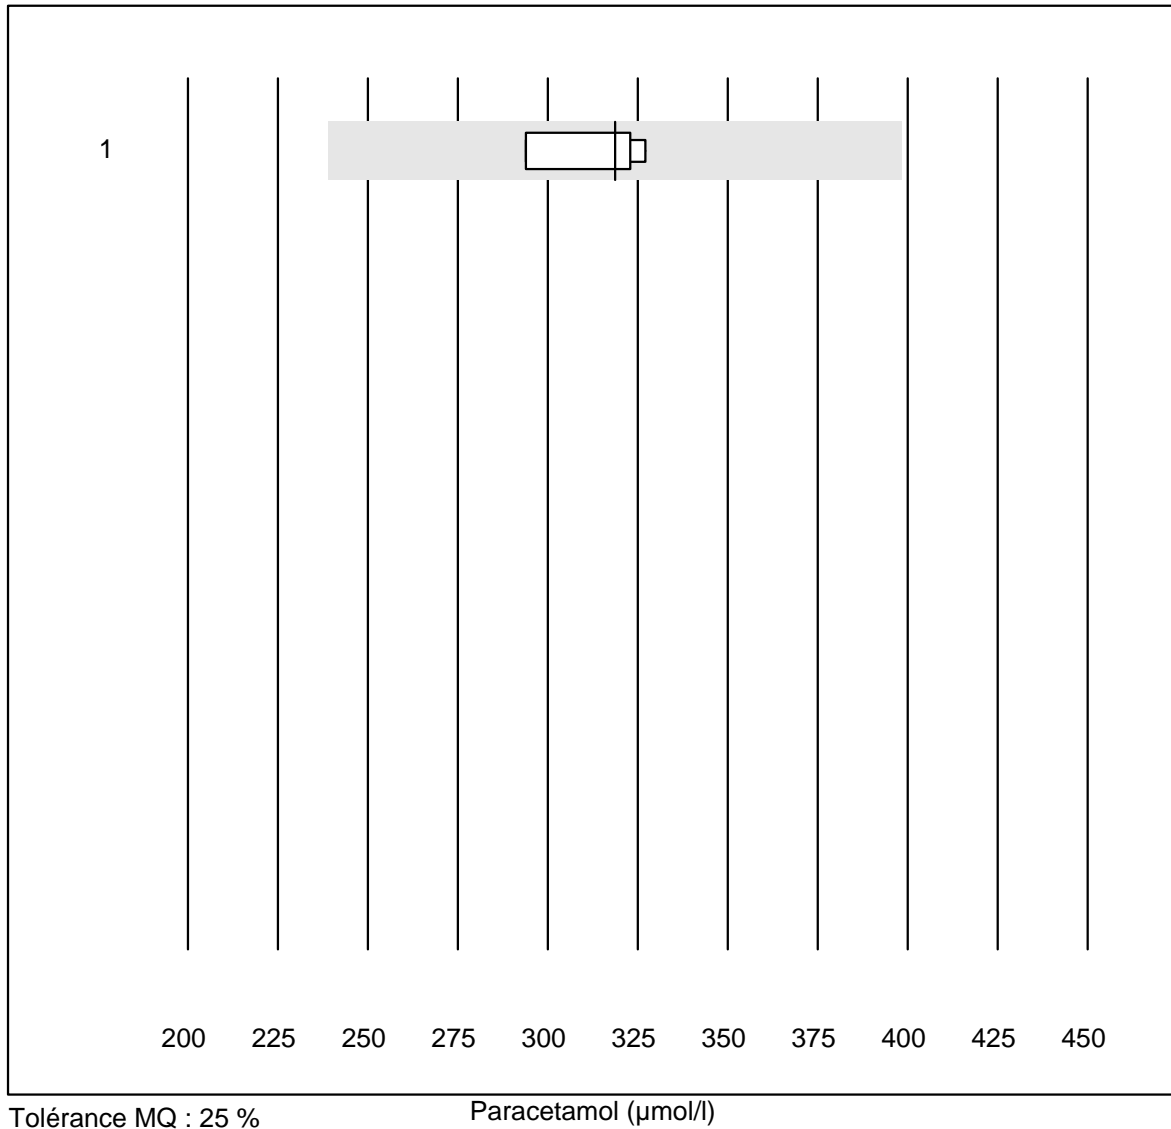


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	318.7	4.7	e

Vancomycin

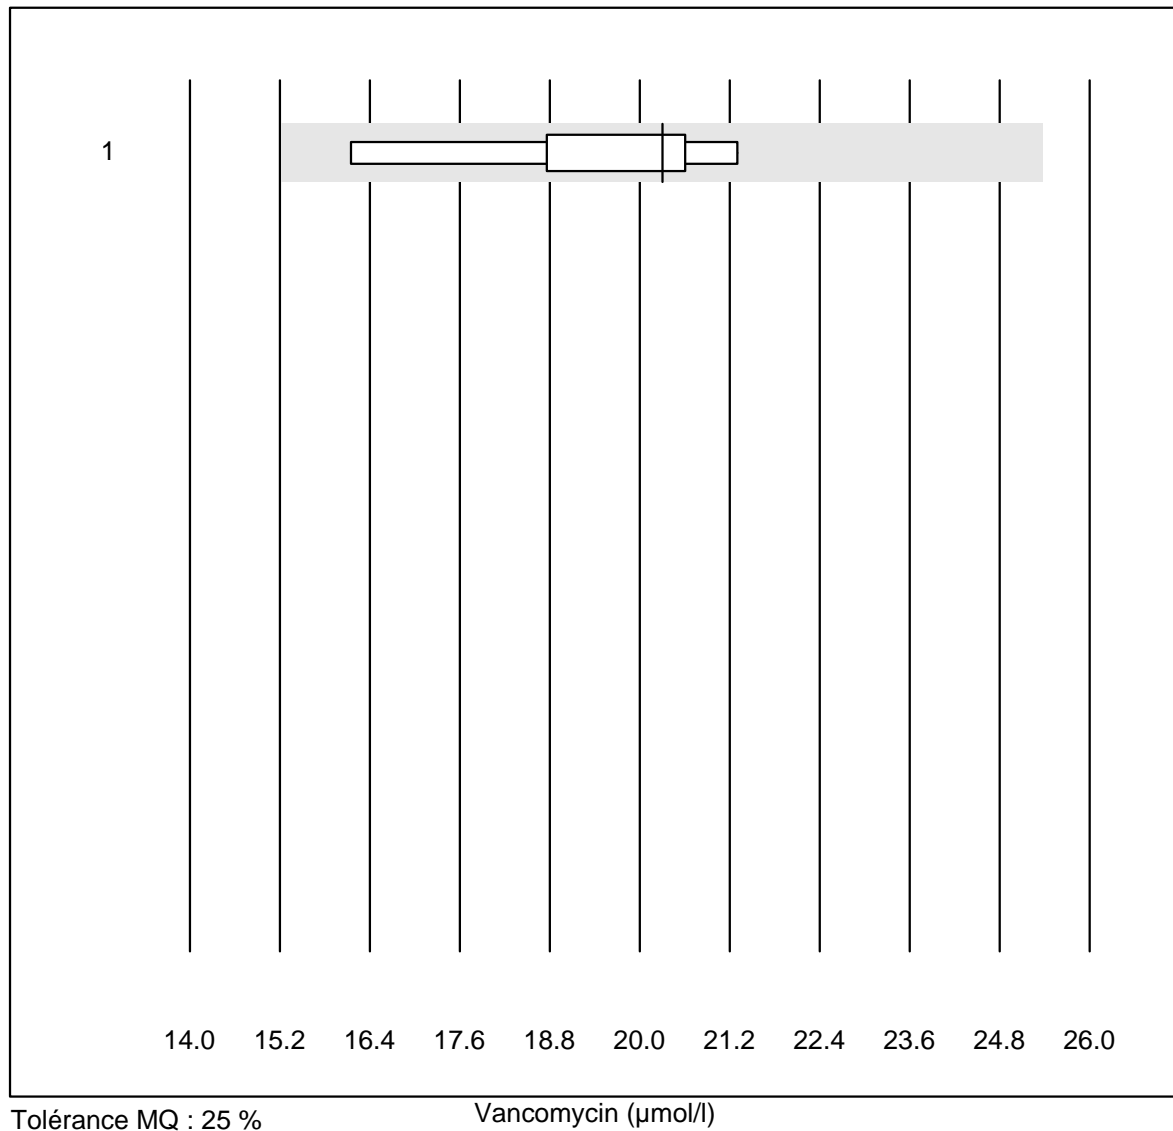

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Architect	5	100.0	0.0	0.0	20	10.6	e*

Valproat

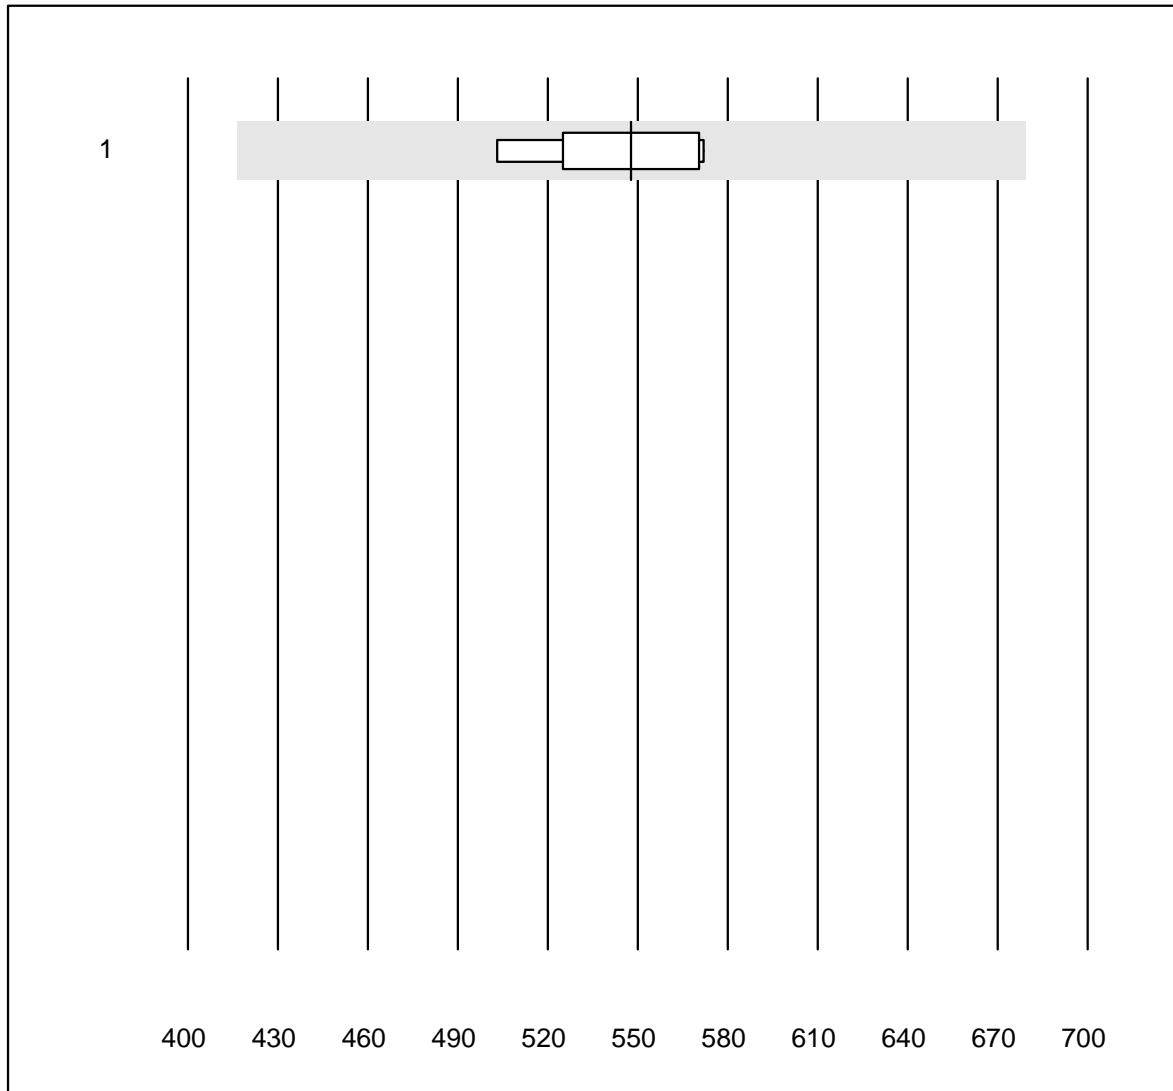


Tolérance MQ : 24 %

Valproat (µmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	547.8	5.3	e

Carbamazépin

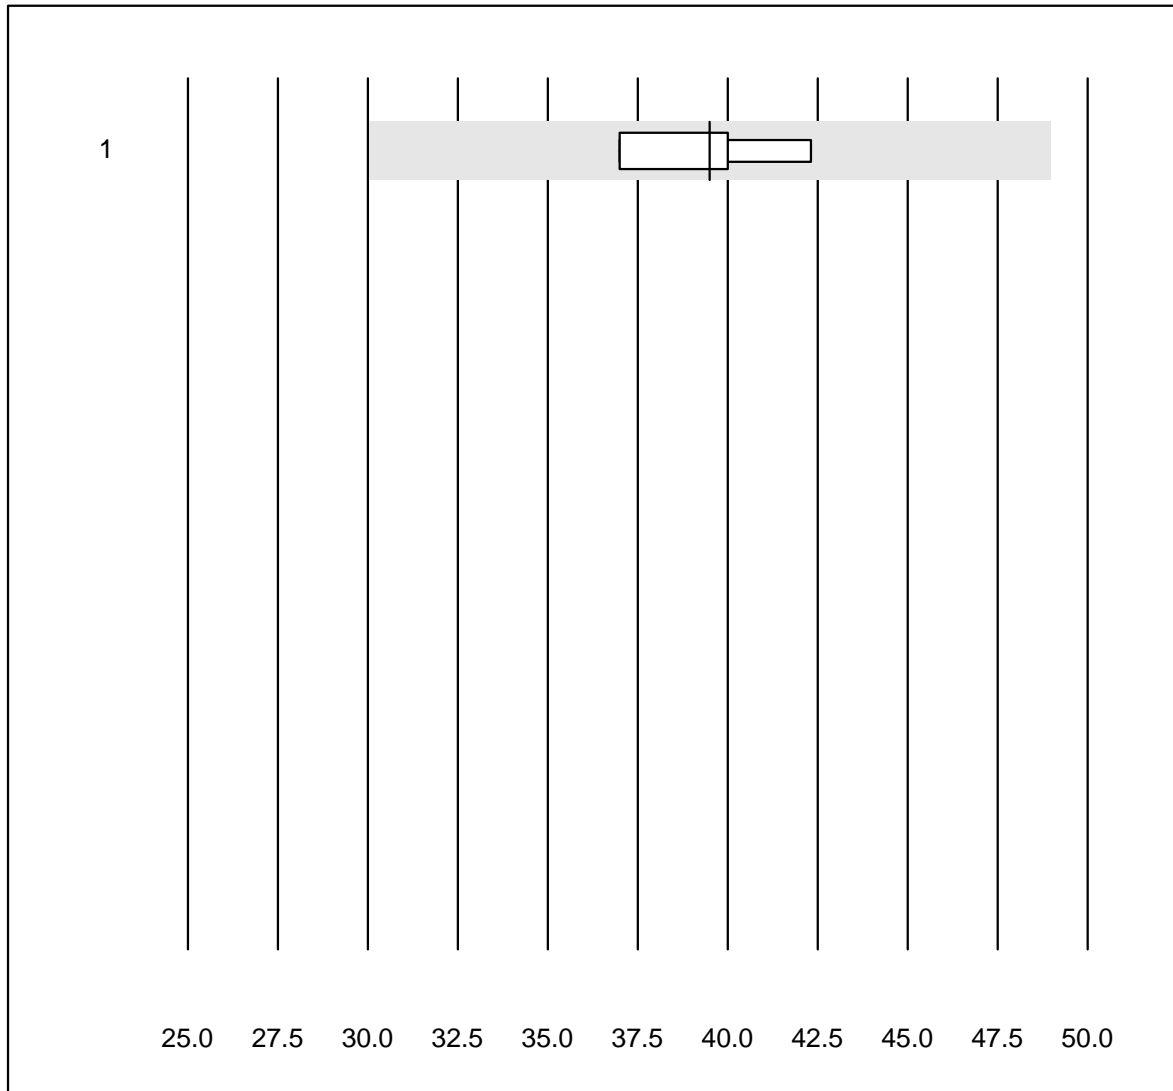


Tolérance MQ : 24 %

Carbamazépin (µmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	39.5	5.6	e

Cystatin C

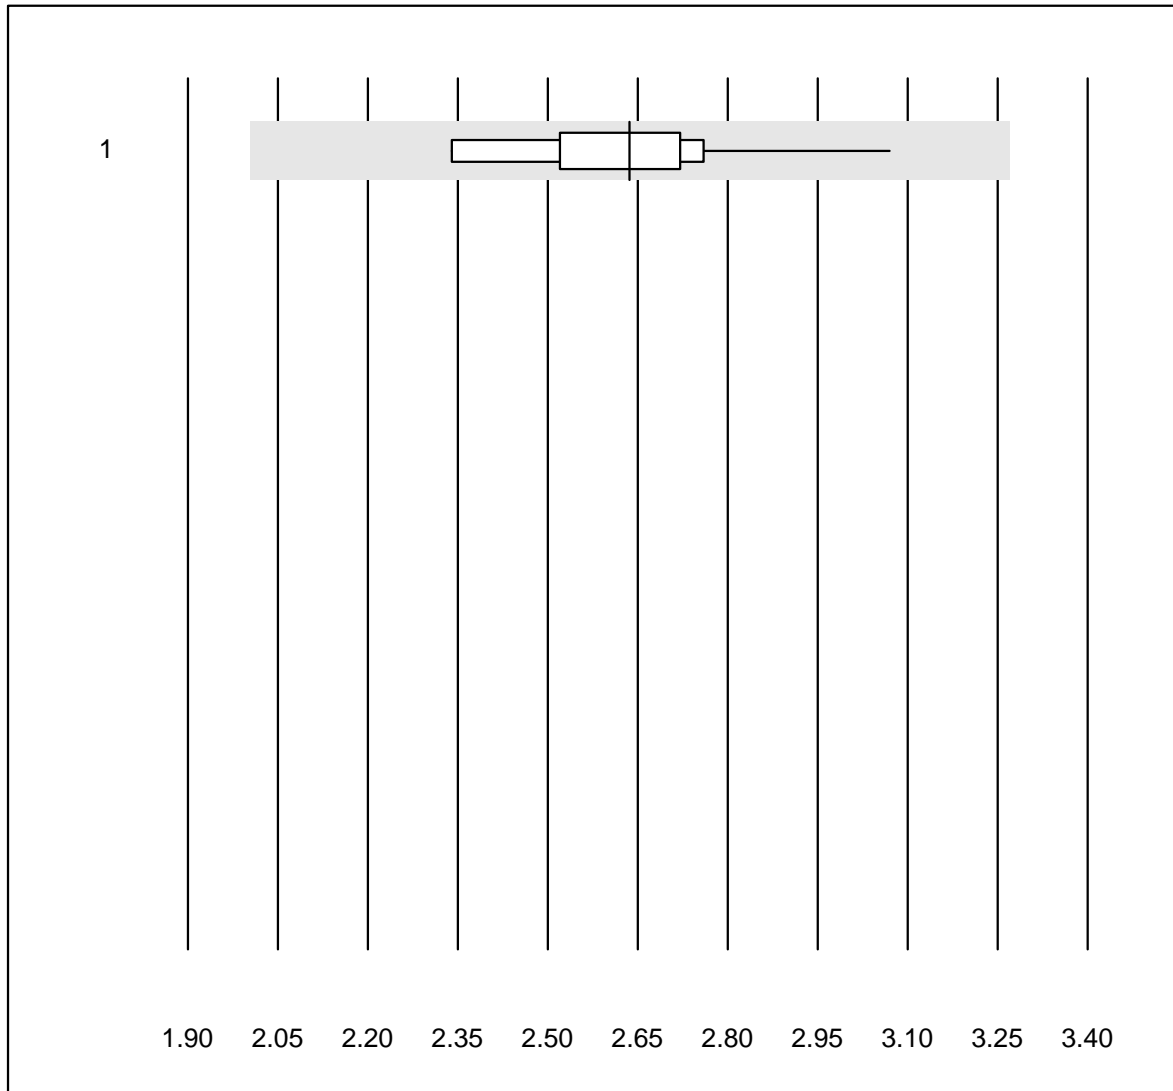


Tolérance MQ : 24 %

Cystatin C (mg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	10	100.0	0.0	0.0	2.64	7.4	e


Éthanol

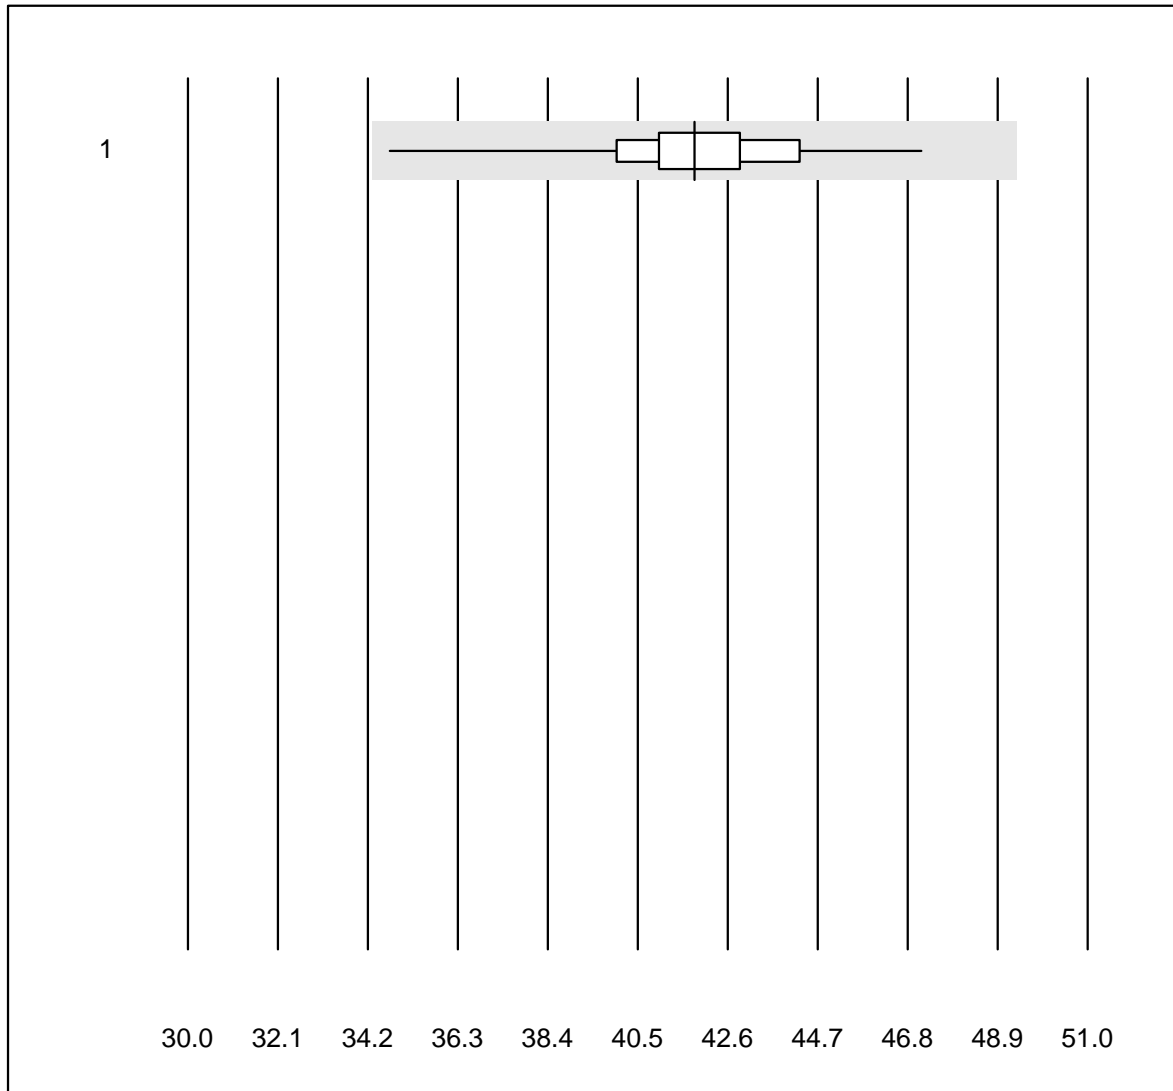

QUALAB Tolérance : 18 % Éthanol (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	27	100.0	0.0	0.0	41.8	5.2	e

Ammoniac

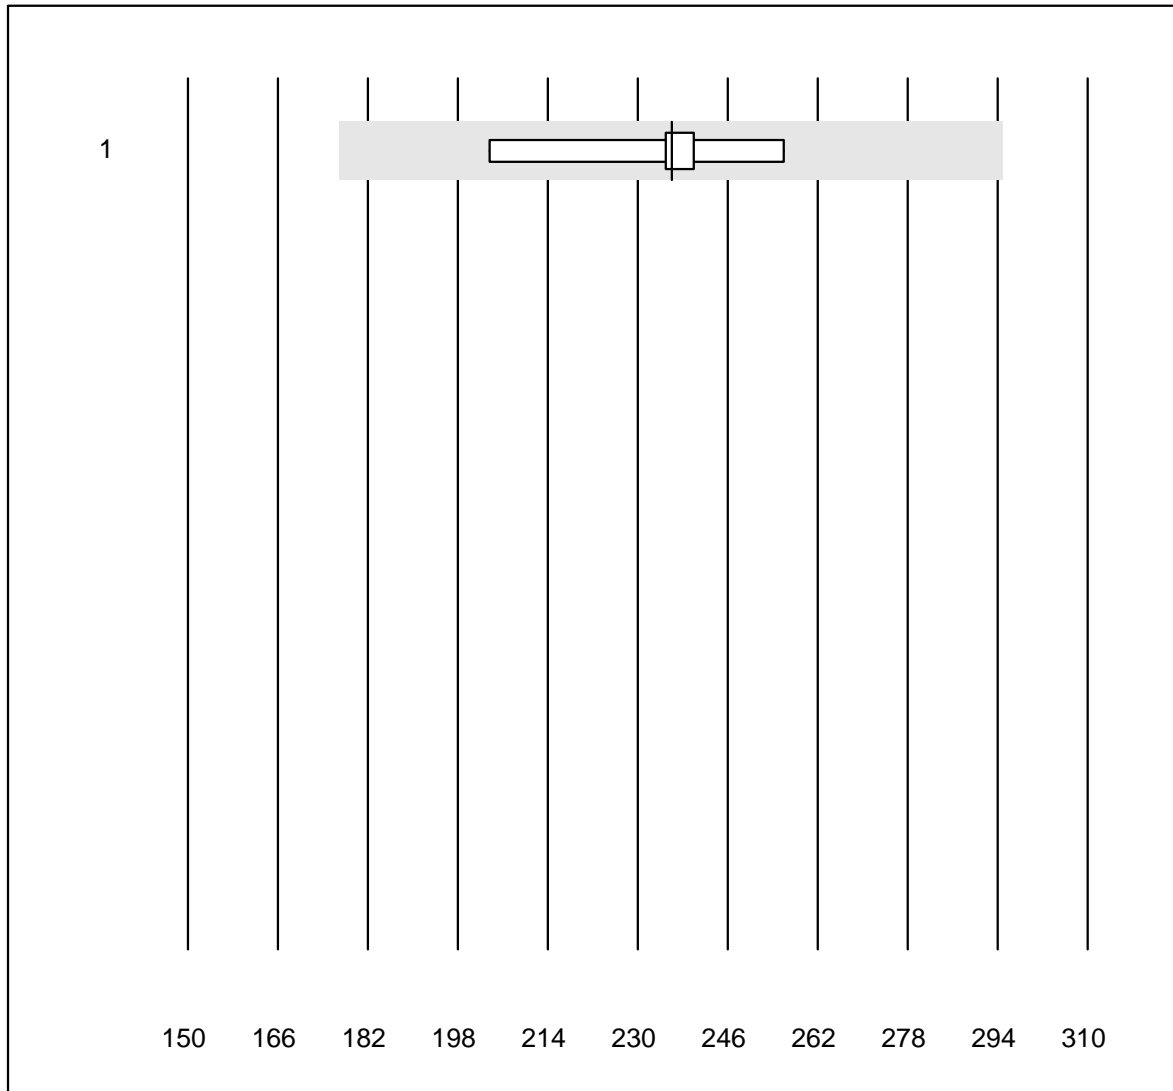


Tolérance MQ : 25 %

Ammoniac (µmol/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	9	100.0	0.0	0.0	236.0	5.8	e

Calprotectine

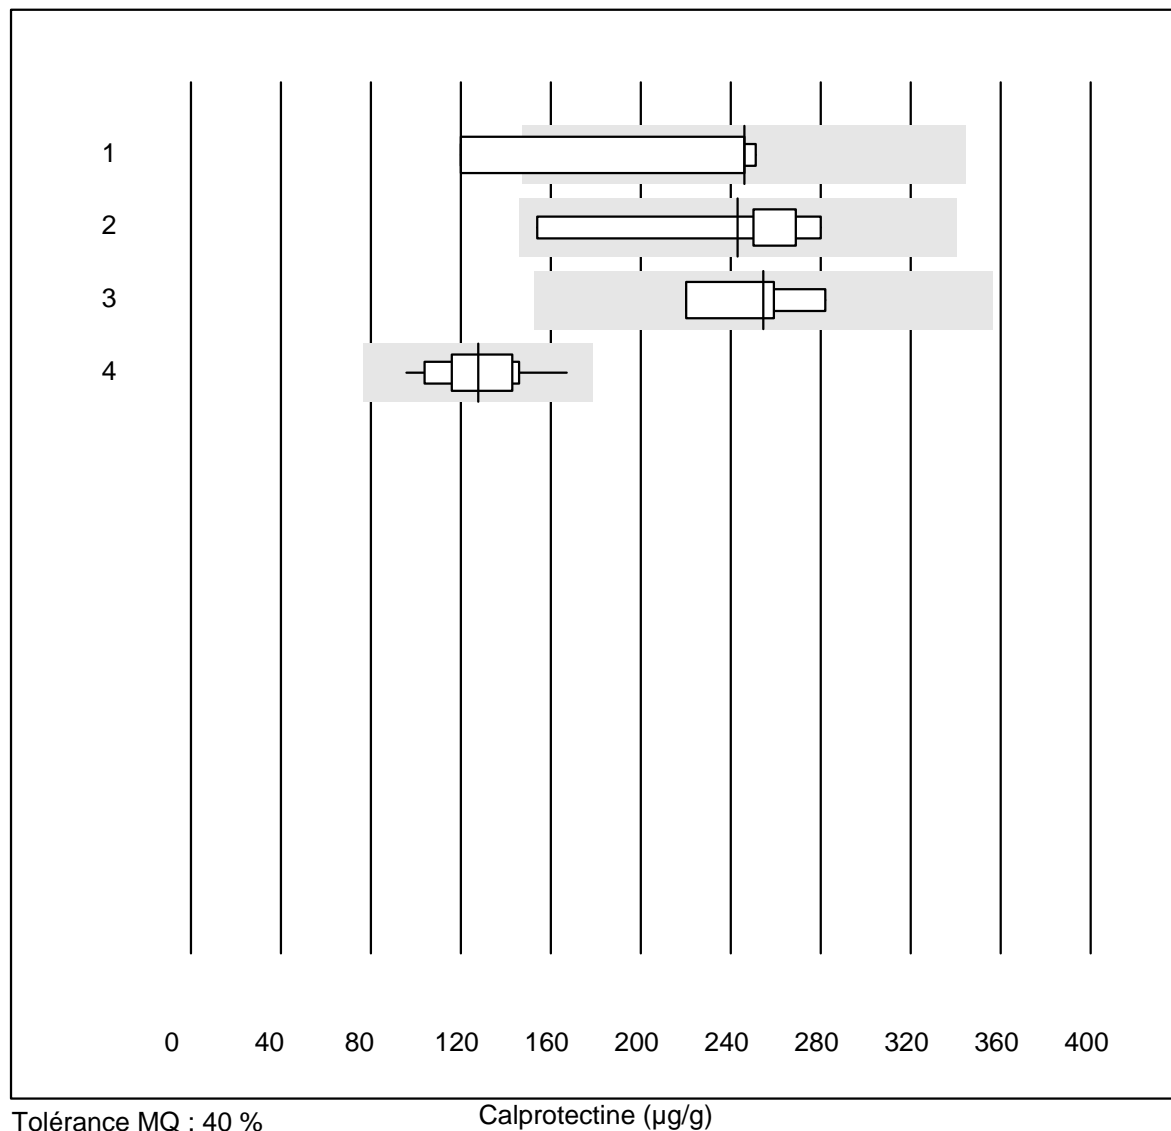

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Bühlmann ELISA	5	60.0	20.0	20.0	246	29.3	e*
2 Bühlmann fCALturbo	11	81.8	0.0	18.2	243	17.9	e*
3 Bühlmann Quantum Blu	4	100.0	0.0	0.0	255	10.2	e*
4 Liaison	19	100.0	0.0	0.0	128	13.3	e

Cholestérol Af/b101

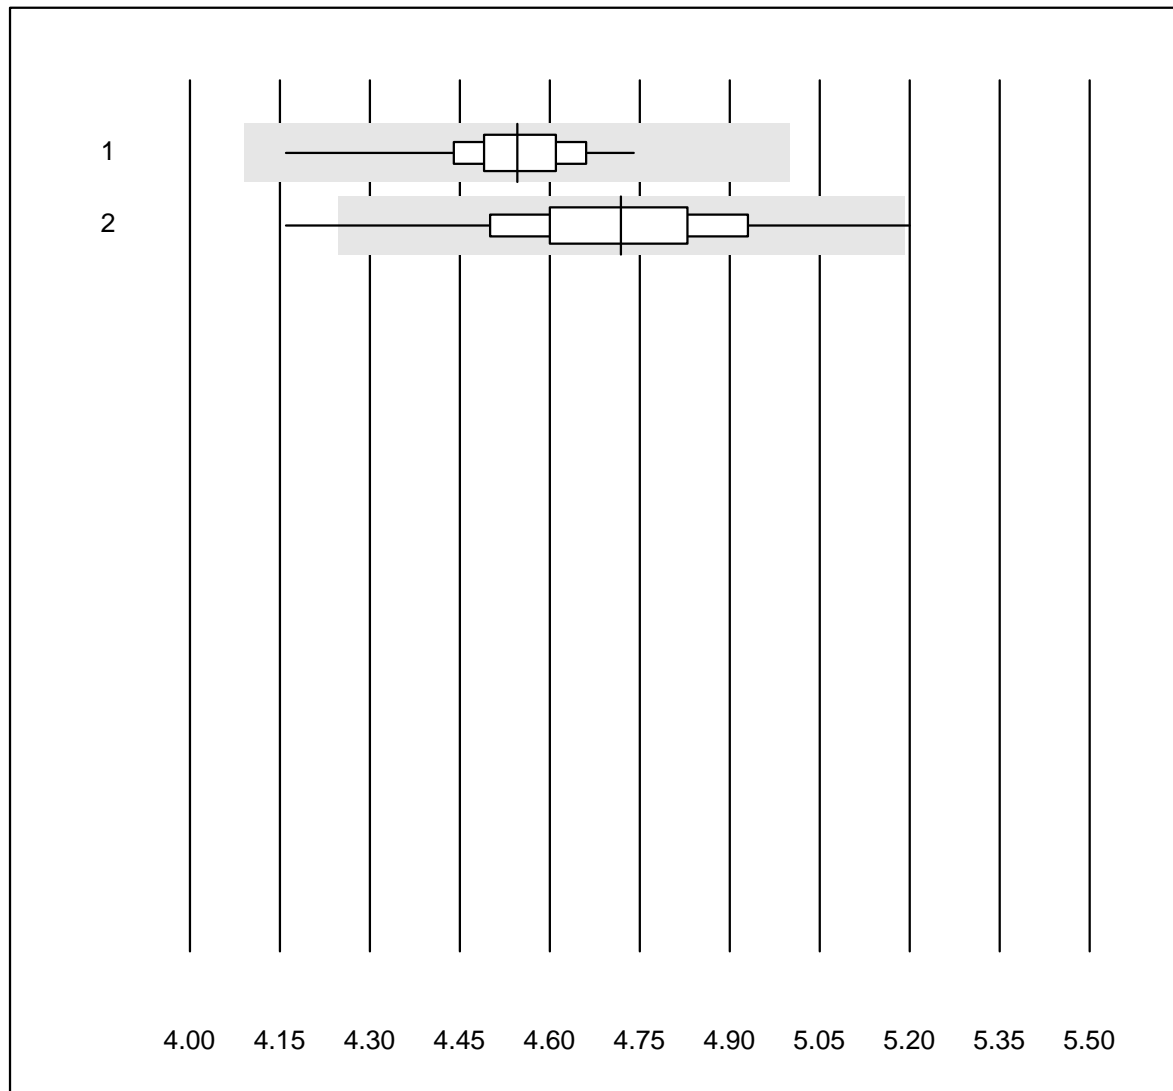


QUALAB Tolérance : 10 %

Cholestérol Af/b101 (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas b101	200	98.5	0.0	1.5	4.55	2.0	e
2 Afinion	449	98.9	0.4	0.7	4.72	3.4	e


Cholestérol HDL Af/b101

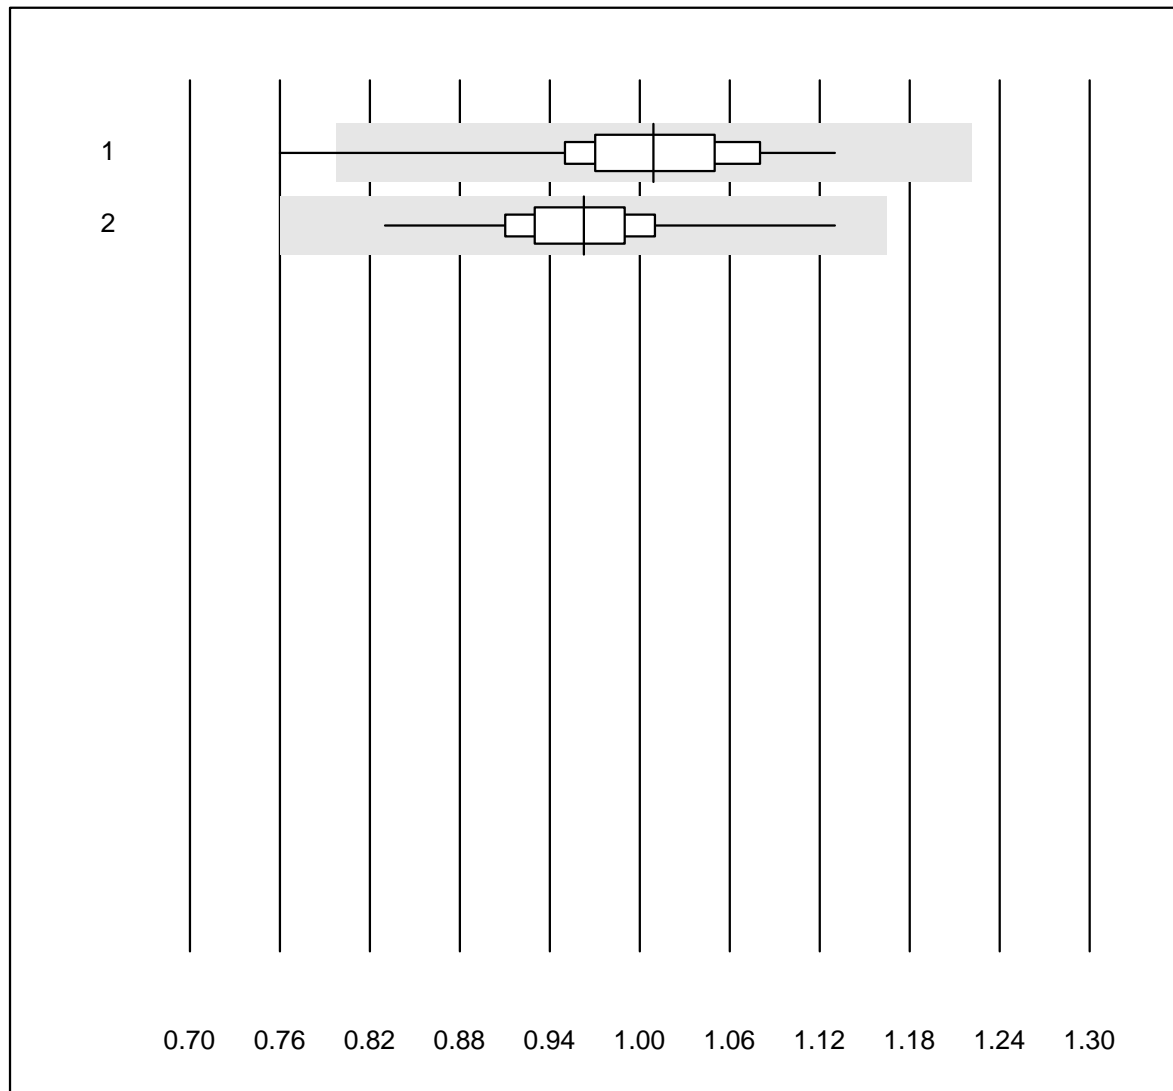

QUALAB Tolérance : 21 % Cholestérol HDL Af/b101 (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas b101	199	87.9	0.5	11.6	1.01	5.8	e
2 Afinion	445	93.5	0.0	6.5	0.96	4.4	e

Triglycerides Af/b101

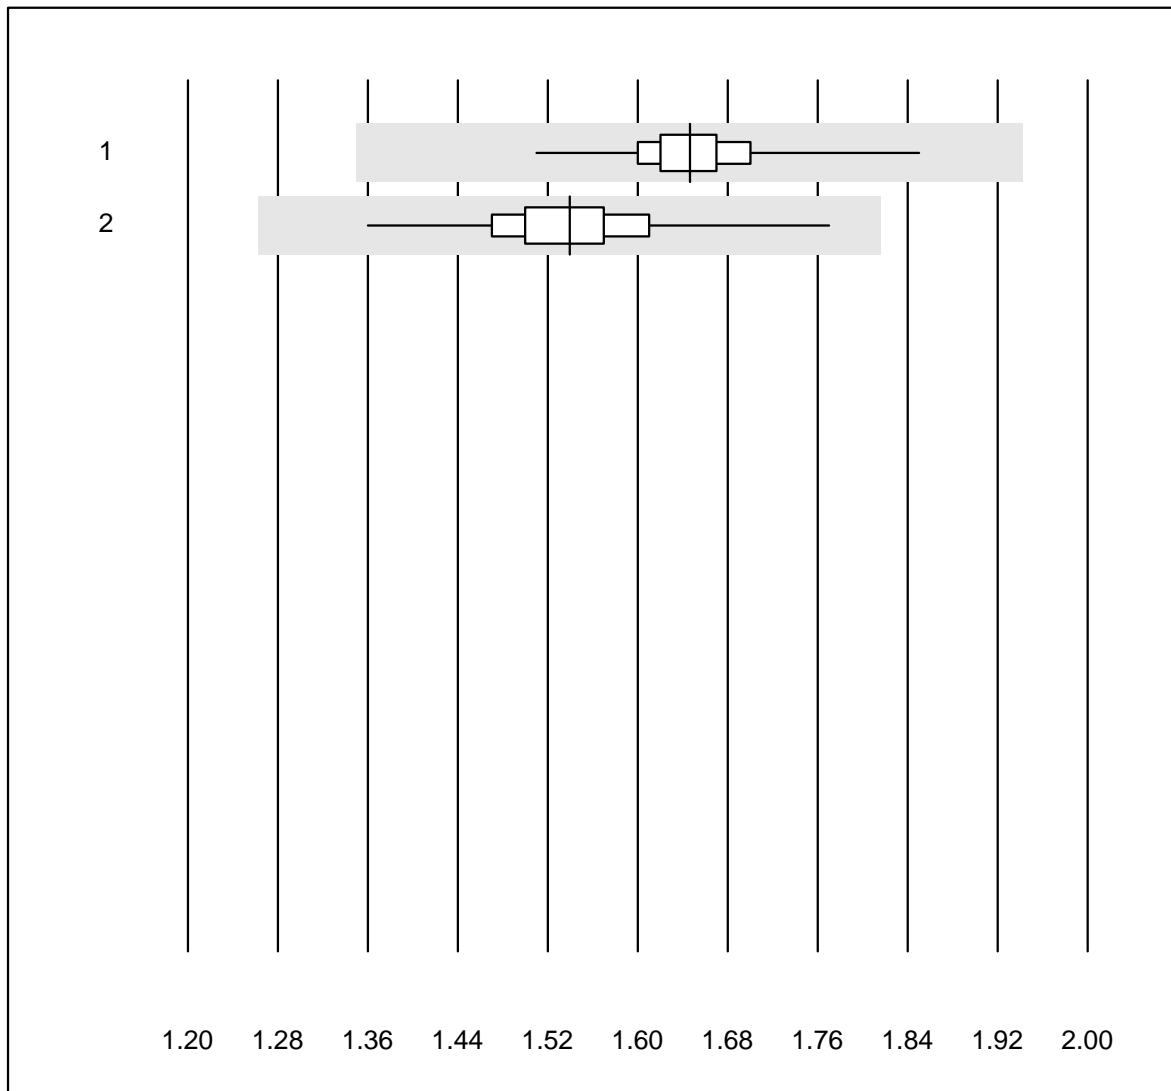


QUALAB Tolérance : 18 %

Triglycerides Af/b101 (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas b101	198	98.0	0.0	2.0	1.65	2.5	e
2 Afinion	449	99.8	0.0	0.2	1.54	3.7	e

Troponine I S

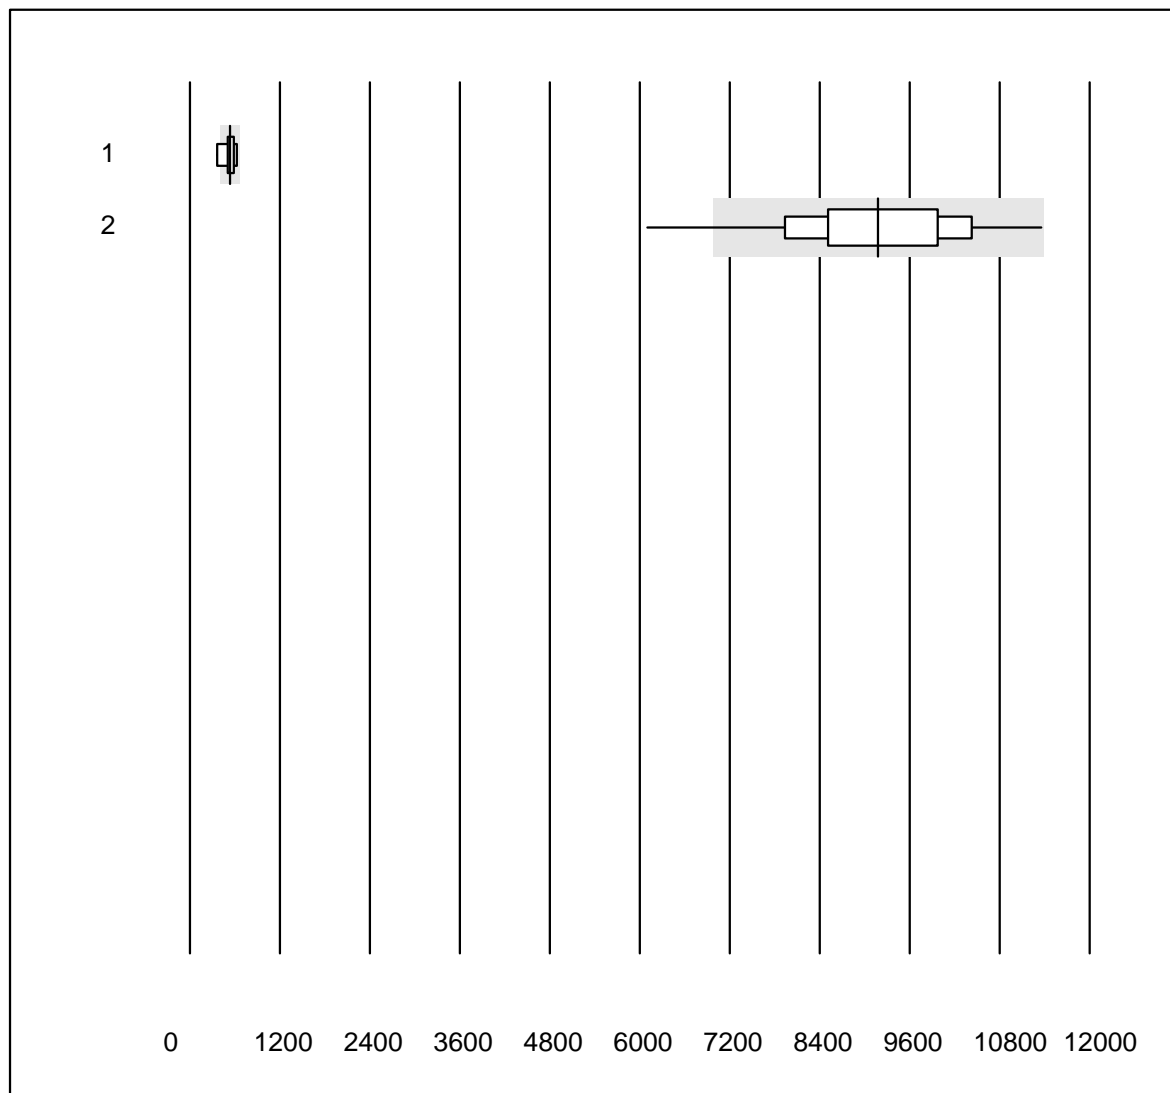


QUALAB Tolérance : 24 %

Troponine I S (ng/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Exdia TRF	8	62.5	12.5	25.0	535.84	17.8	e*
2 AFIAS	170	89.4	2.4	8.2	9179.02	10.9	e

D-Dimères qn S

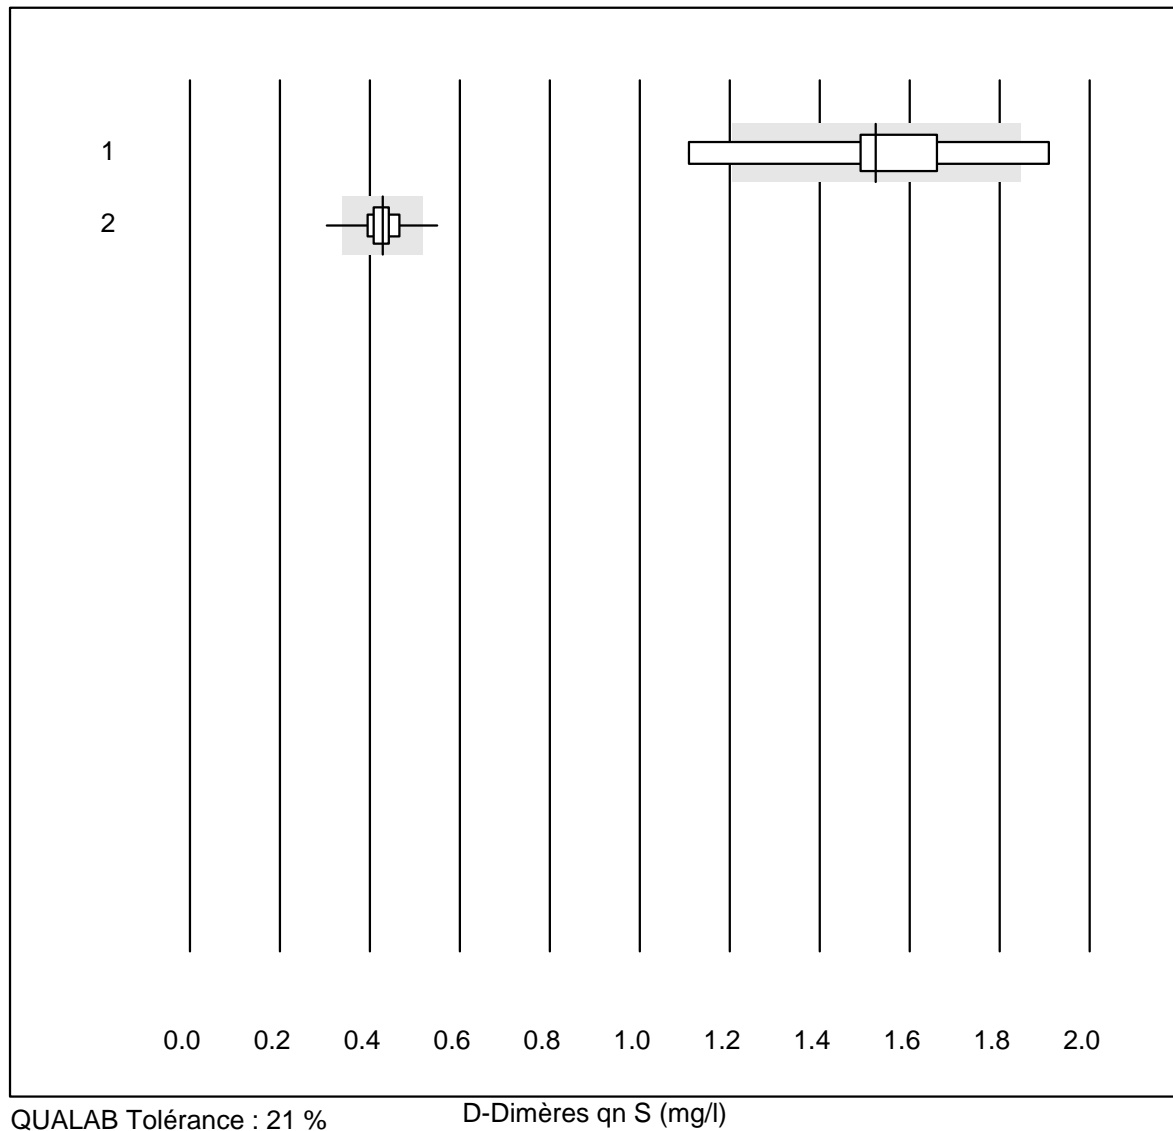

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Exdia TRF	8	37.5	25.0	37.5	1.53	18.8	e*
2 AFIAS	177	90.4	1.7	7.9	0.43	7.5	e

NT-proBNP S

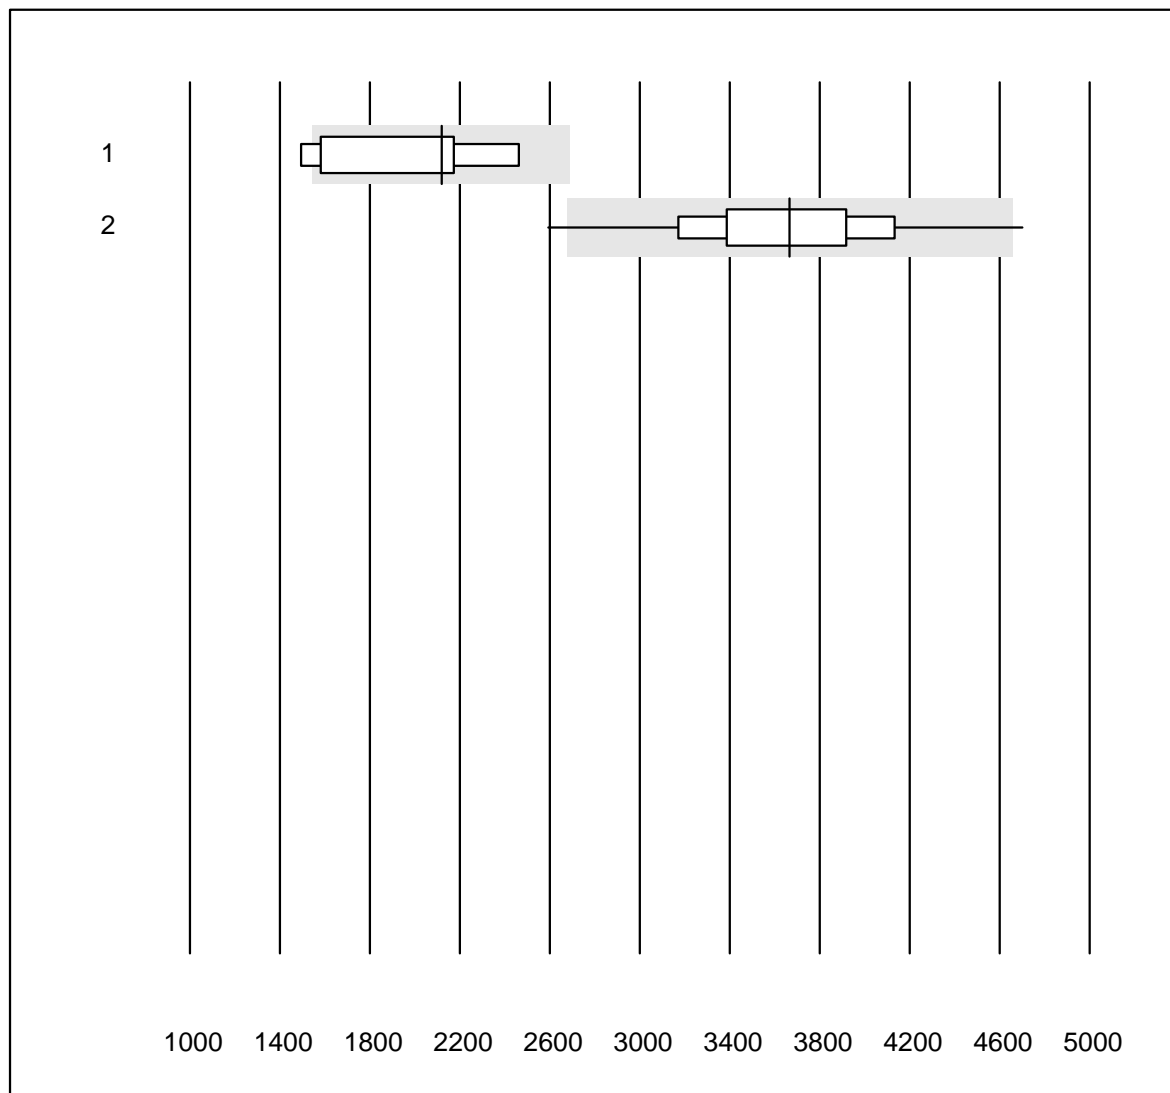


QUALAB Tolérance : 27 %

NT-proBNP S (ng/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Exdia TRF	8	50.0	12.5	37.5	2117.8	20.9	e*
2 AFIAS	129	97.6	1.6	0.8	3666.8	10.3	e

Lipase

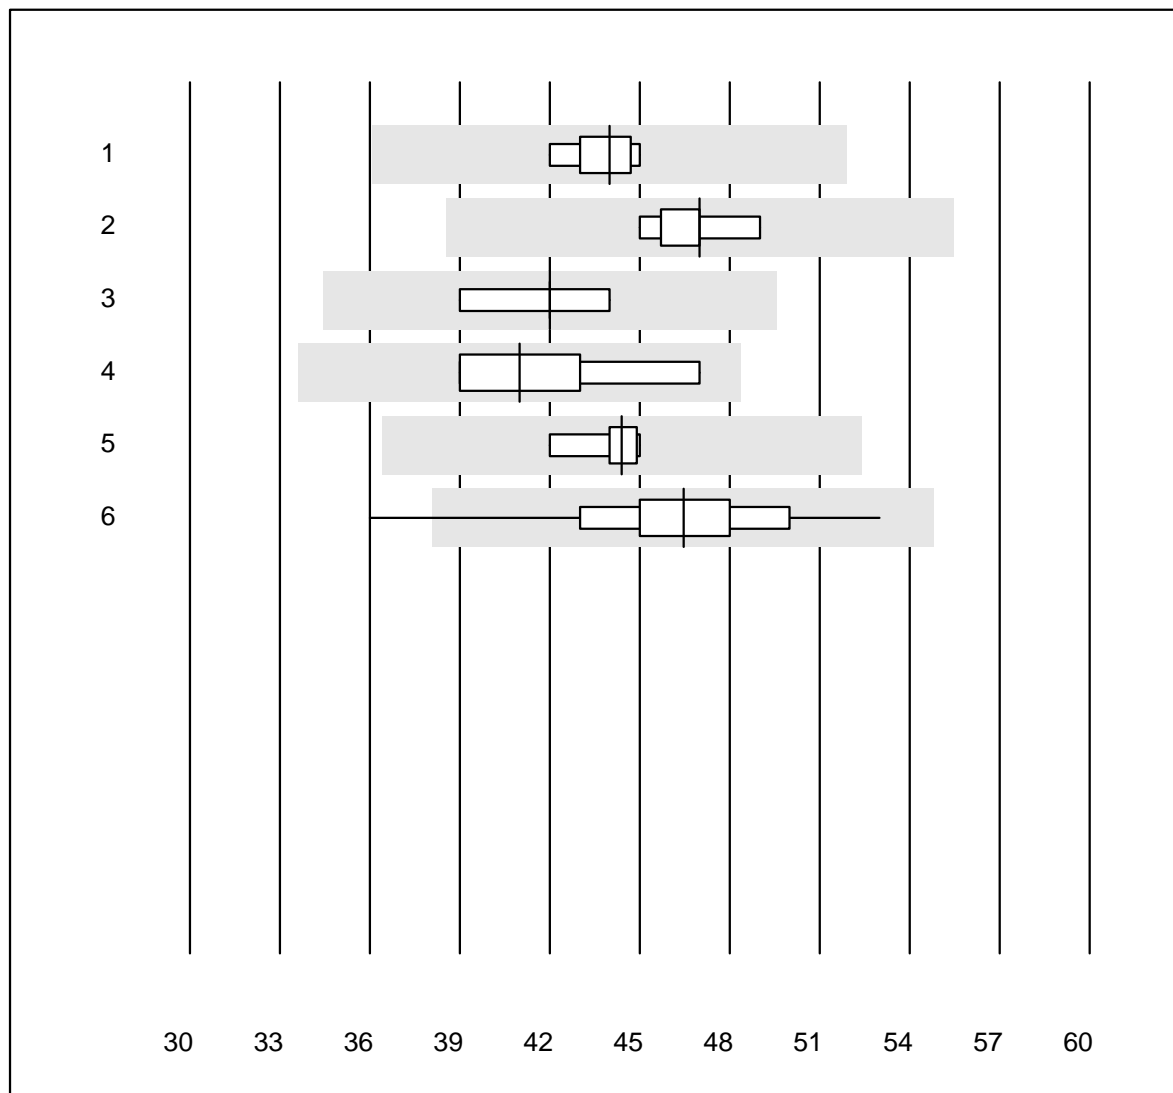


QUALAB Tolérance : 18 %

Lipase (U/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Roche	7	100.0	0.0	0.0	44.0	2.4	e
2 Alinity	5	100.0	0.0	0.0	47.0	3.3	e
3 Architect	5	100.0	0.0	0.0	42.0	4.3	e
4 Beckman	7	100.0	0.0	0.0	41.0	6.7	e*
5 Cobas	6	100.0	0.0	0.0	44.4	2.6	e
6 Fuji Dri-Chem	148	98.6	0.7	0.7	46.5	6.1	e

Bicarbonat

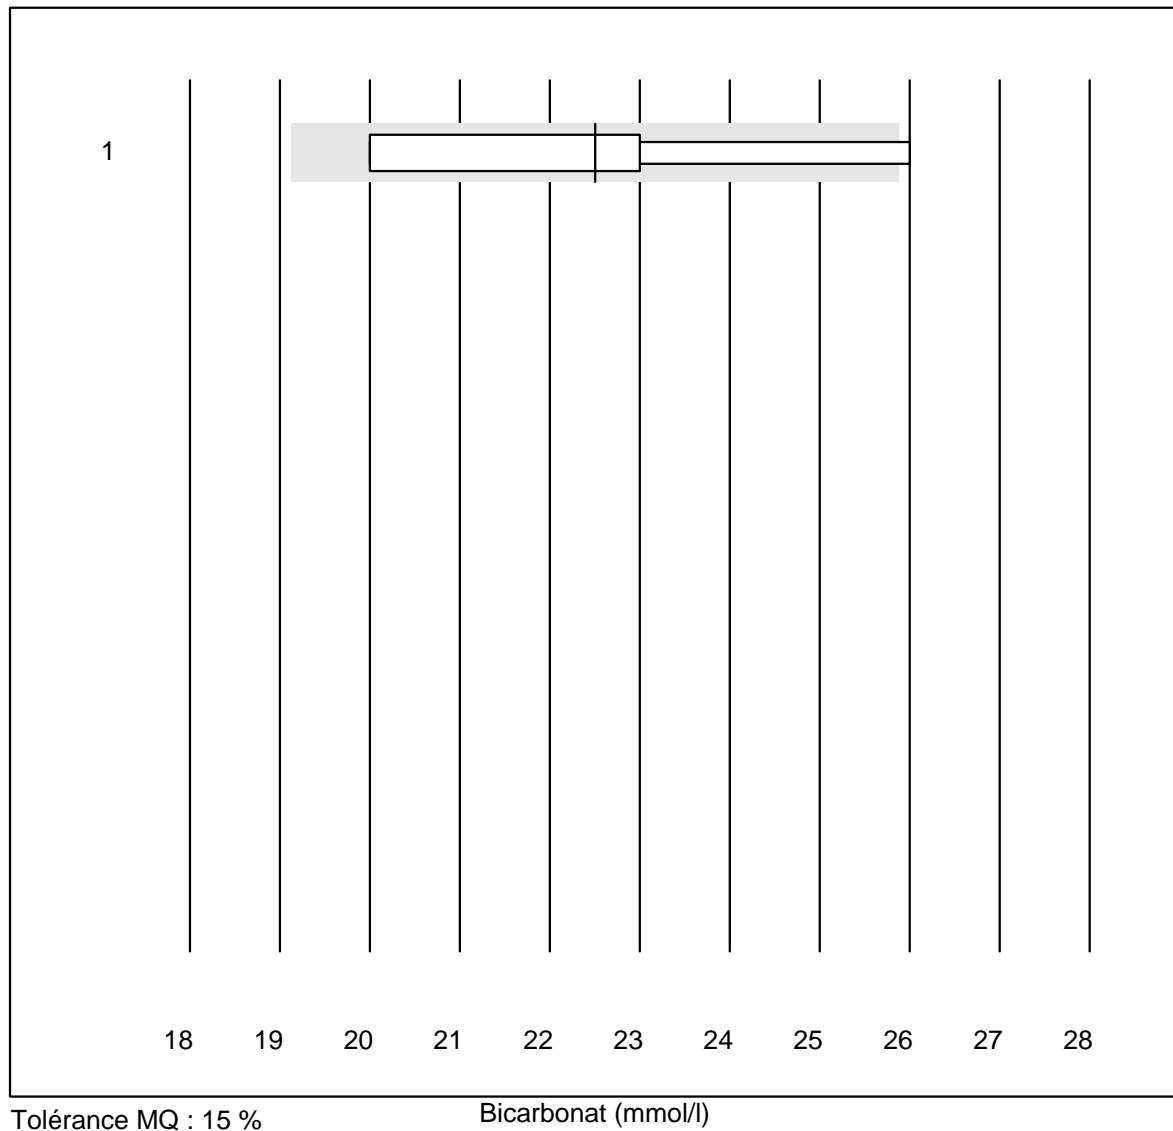


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Piccolo	4	75.0	25.0	0.0	22.5	11.0	e*

Cholinestérase

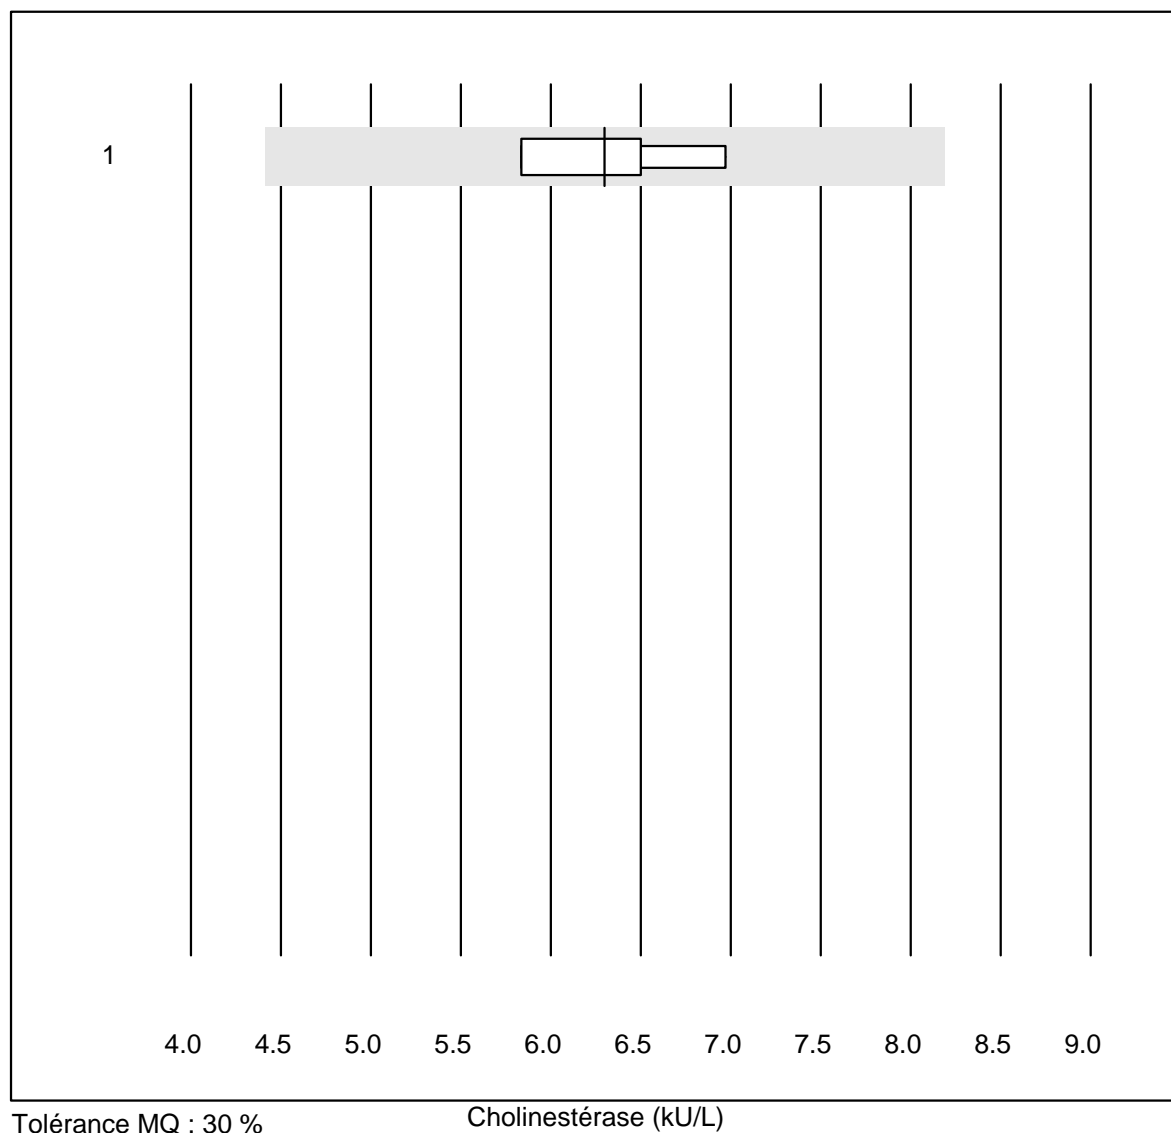

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	6.3	7.8	e*

Glucose CSF

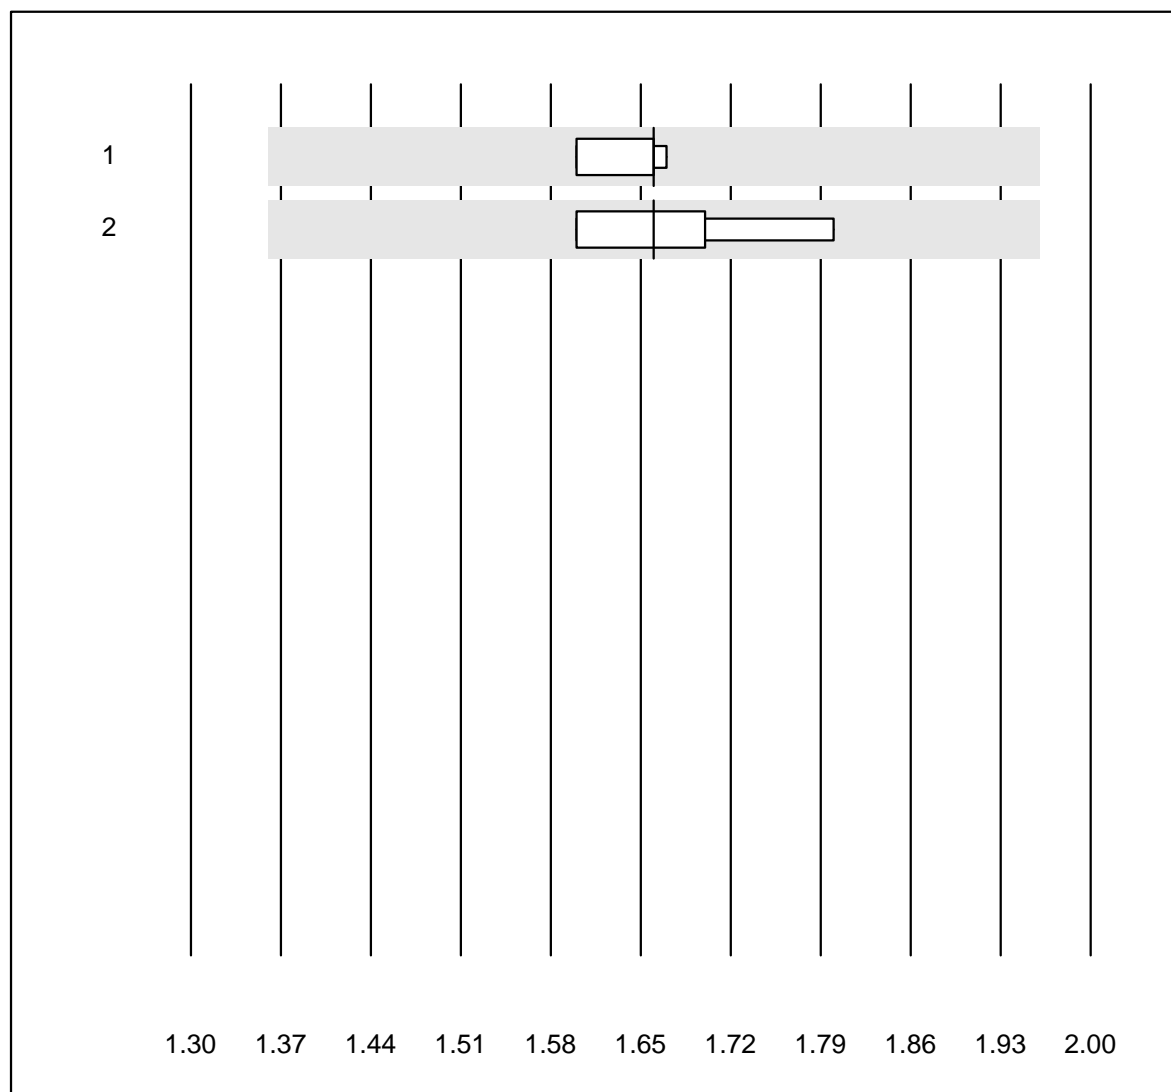


QUALAB Tolérance : 9 %
(< 3.30: +/- 0.30 mmol/l)

Glucose CSF (mmol/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	1.66	1.9	e
2 Autres méthodes	9	100.0	0.0	0.0	1.66	4.4	e*

Lactate CSF

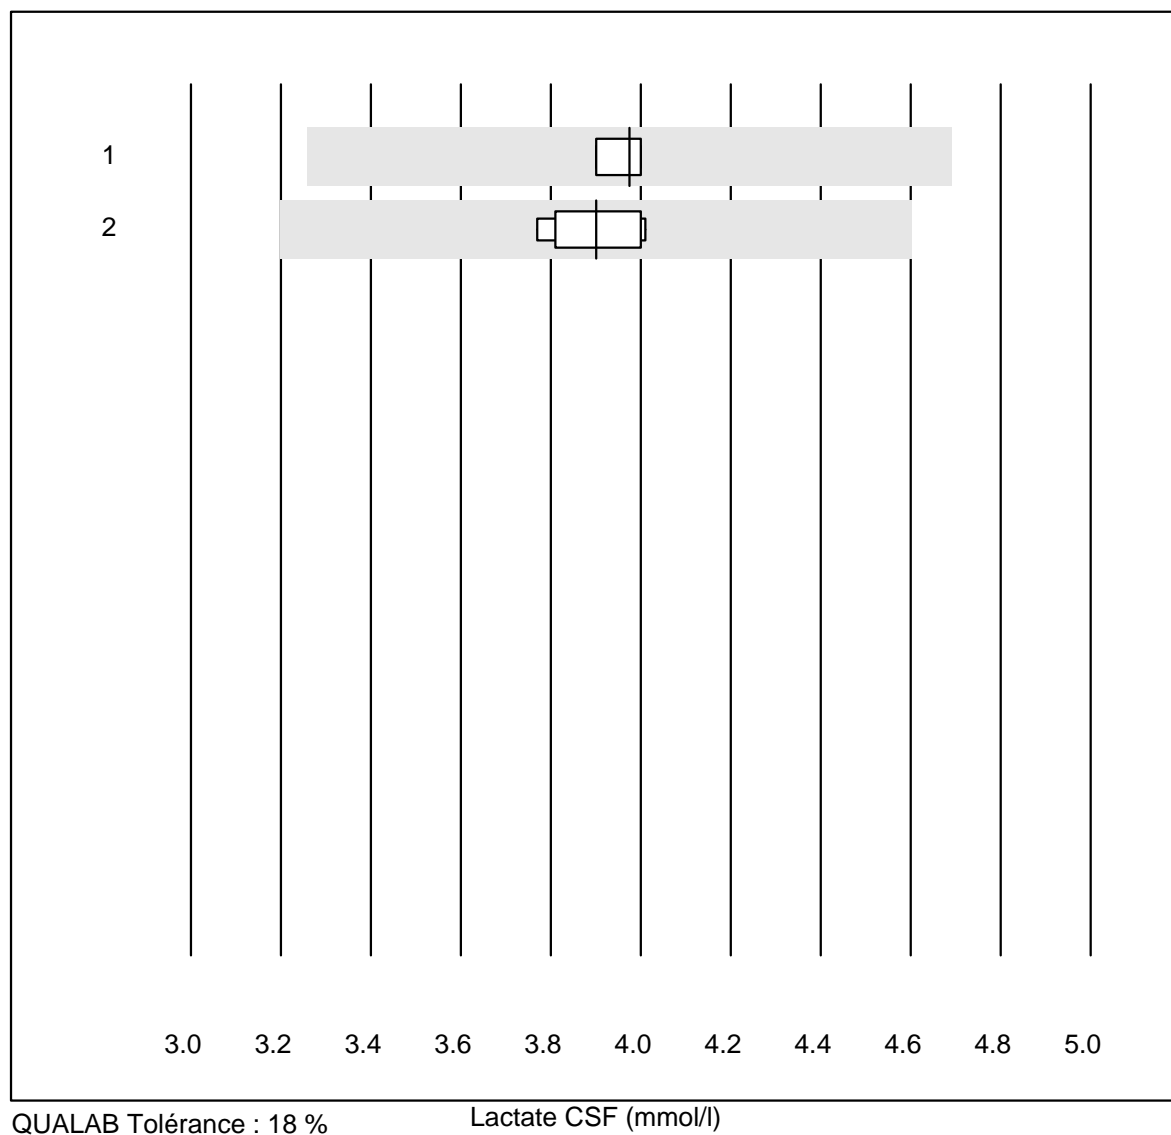

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	3.98	1.2	e
2 Autres méthodes	7	100.0	0.0	0.0	3.90	2.3	e

Protéine CSF

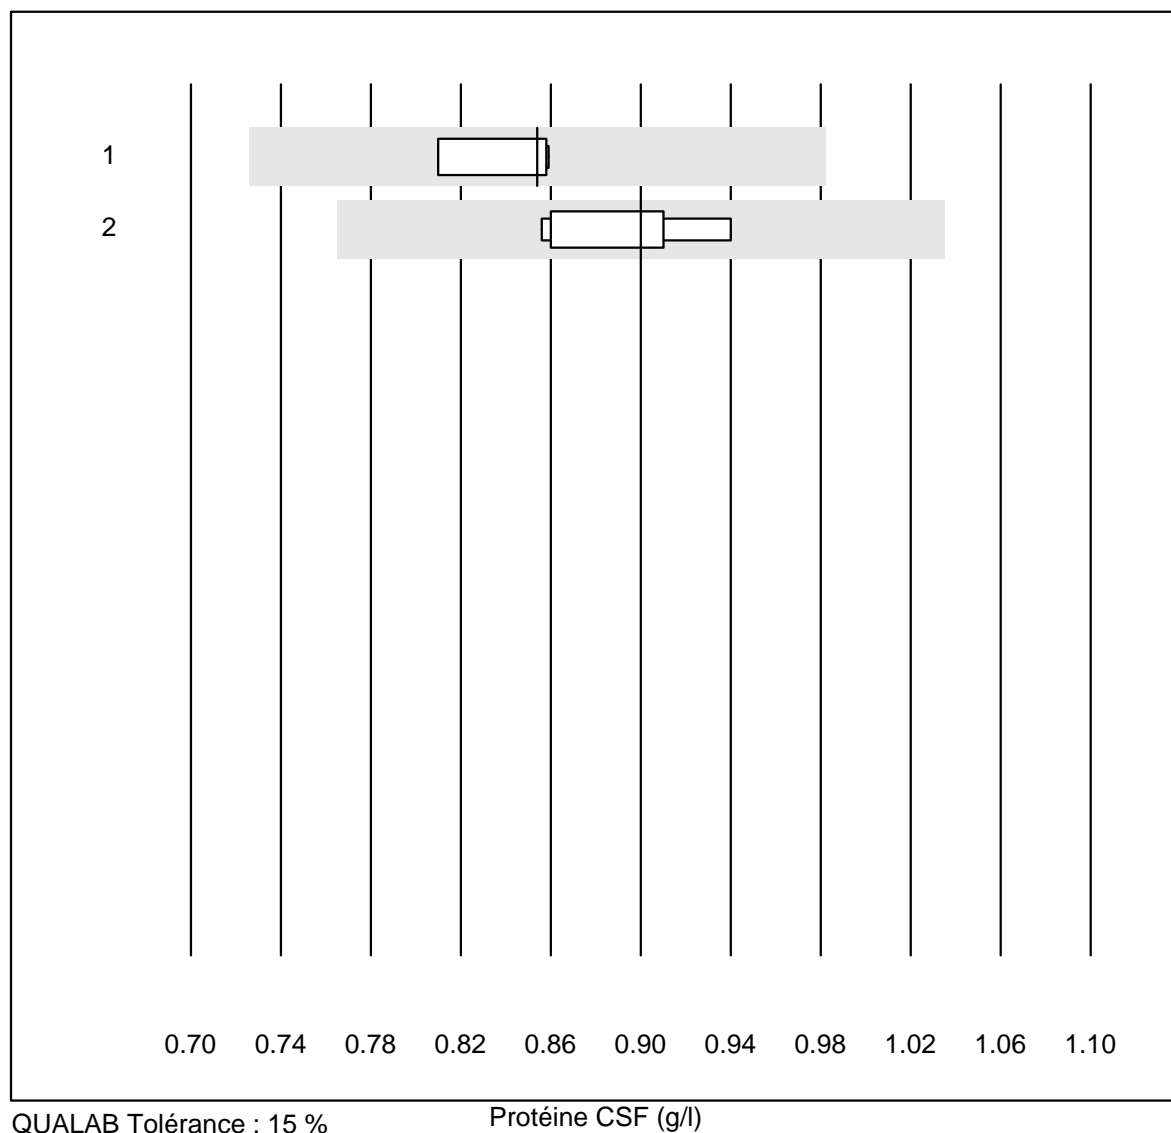


QUALAB Tolérance : 15 %

Protéine CSF (g/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	0.85	2.7	e
2 Autres méthodes	7	85.7	0.0	14.3	0.90	3.9	e

Cyclosporin

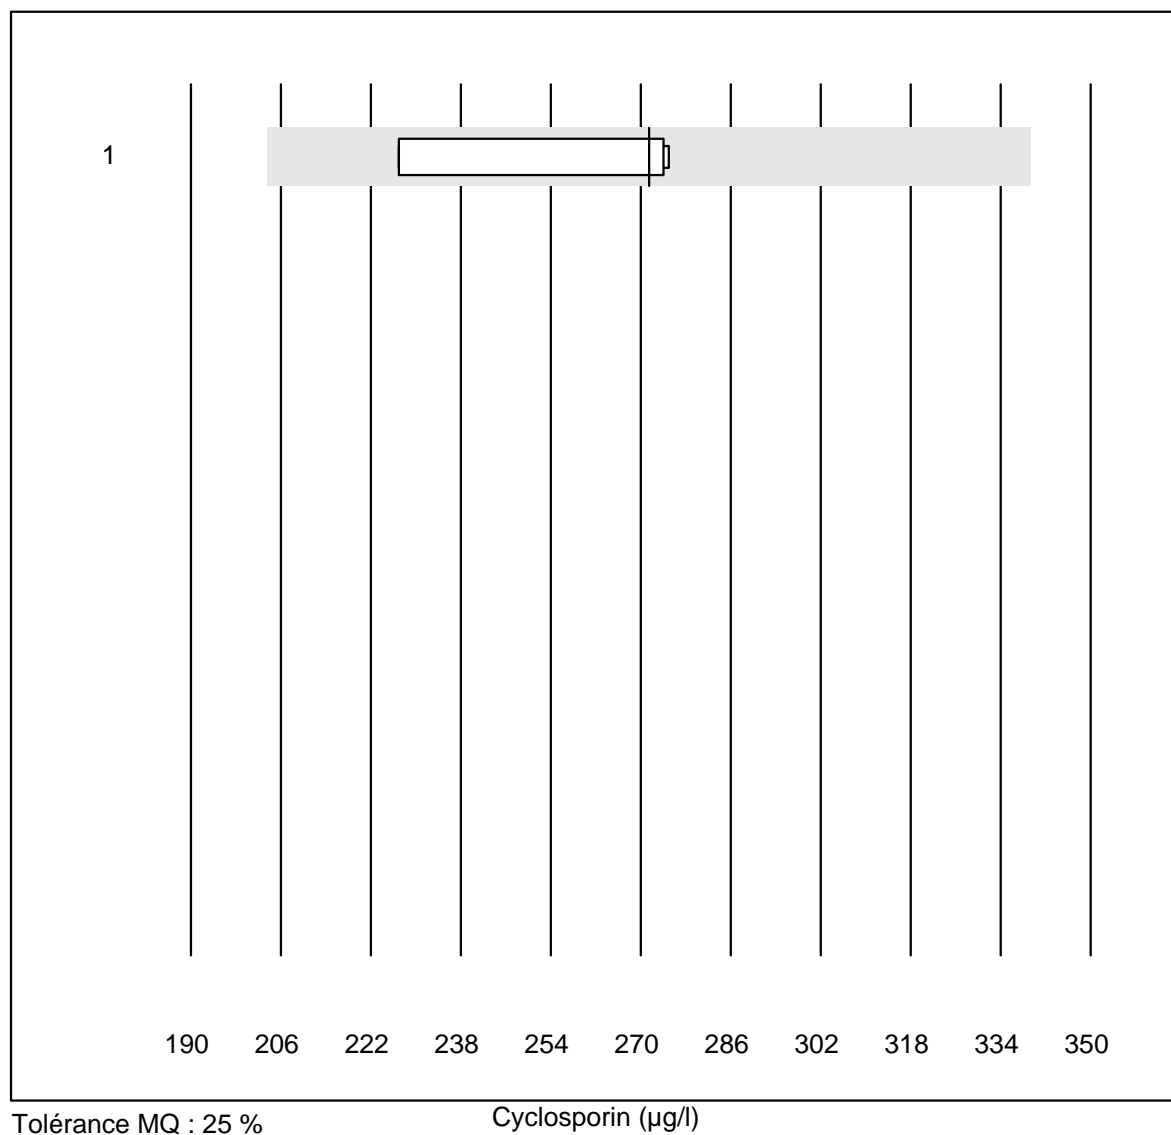


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Architect	4	100.0	0.0	0.0	271.5	8.8	e*

Tacrolimus

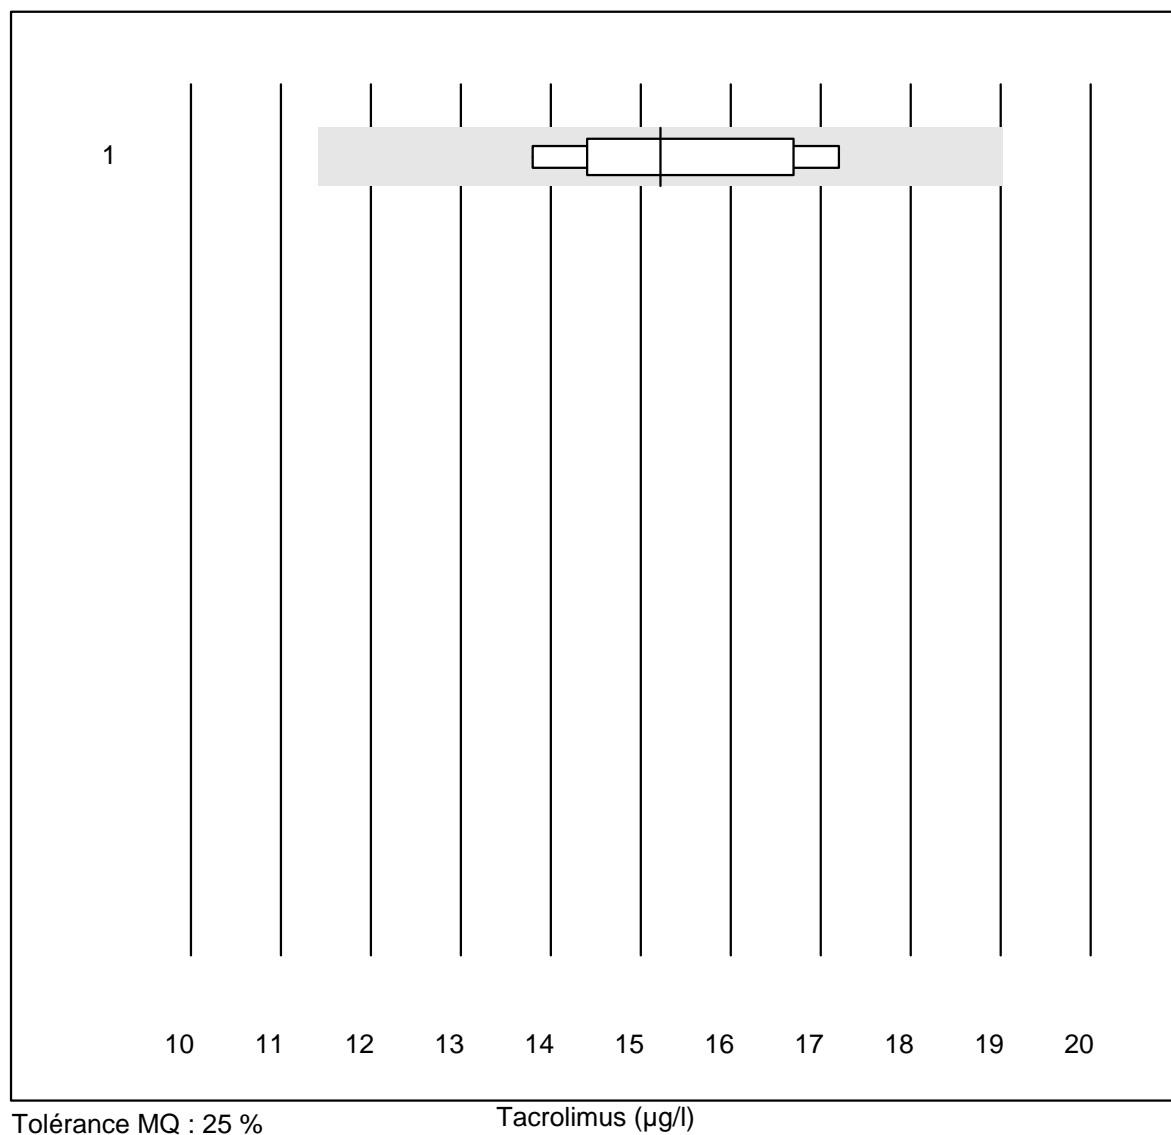

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	8	100.0	0.0	0.0	15.2	8.2	e

Totalprotein E

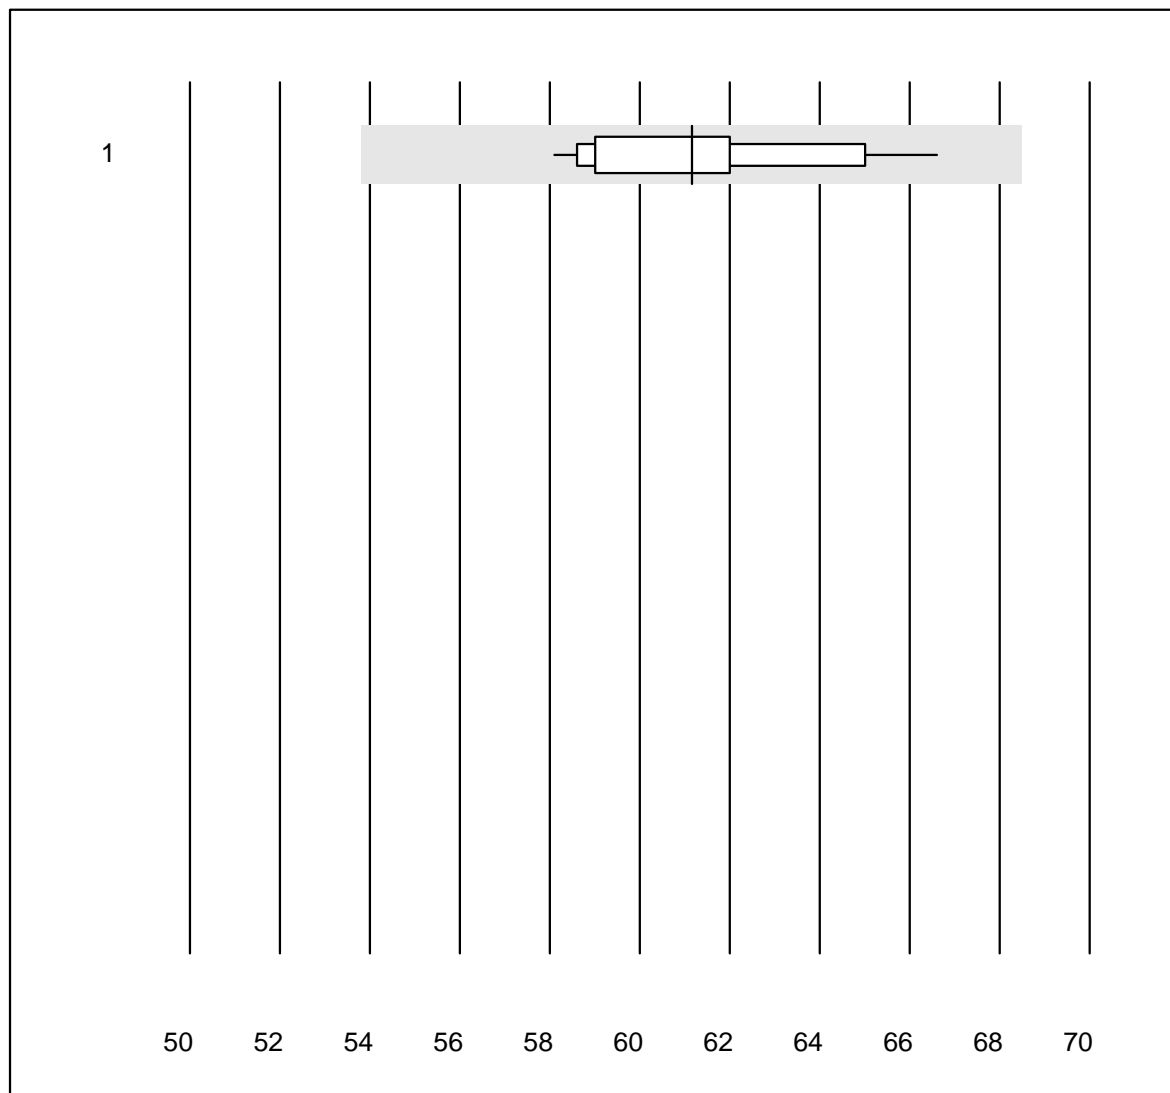


Tolérance MQ : 12 %

Totalprotein E (g/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	13	100.0	0.0	0.0	61.2	4.2	e

Albumin E

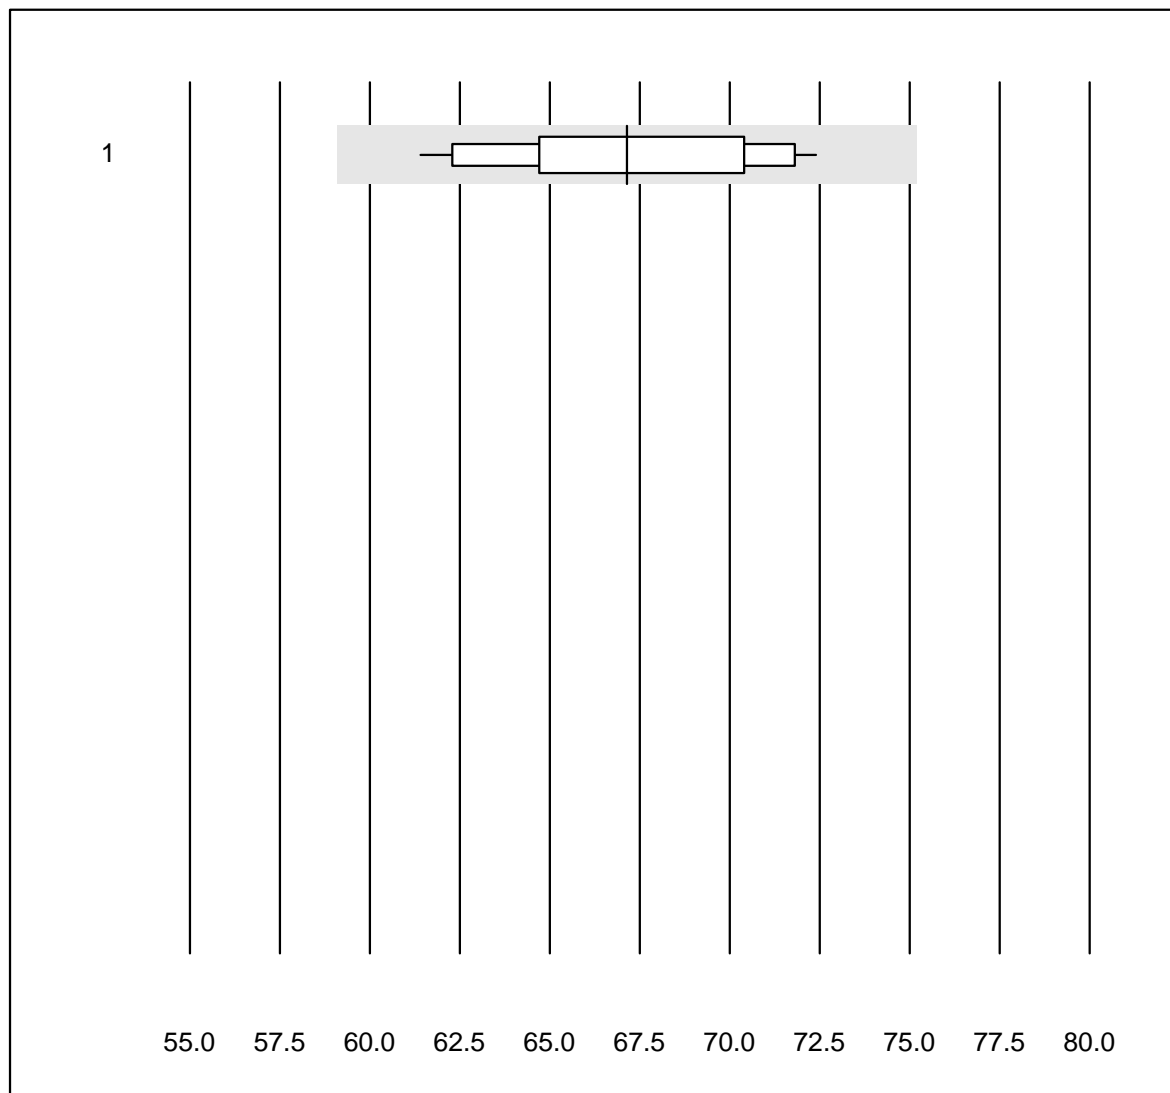


Tolérance MQ : 12 %

Albumin E (%)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 électrophorèse	19	100.0	0.0	0.0	67.1	4.8	e

alpha-1-Globuline

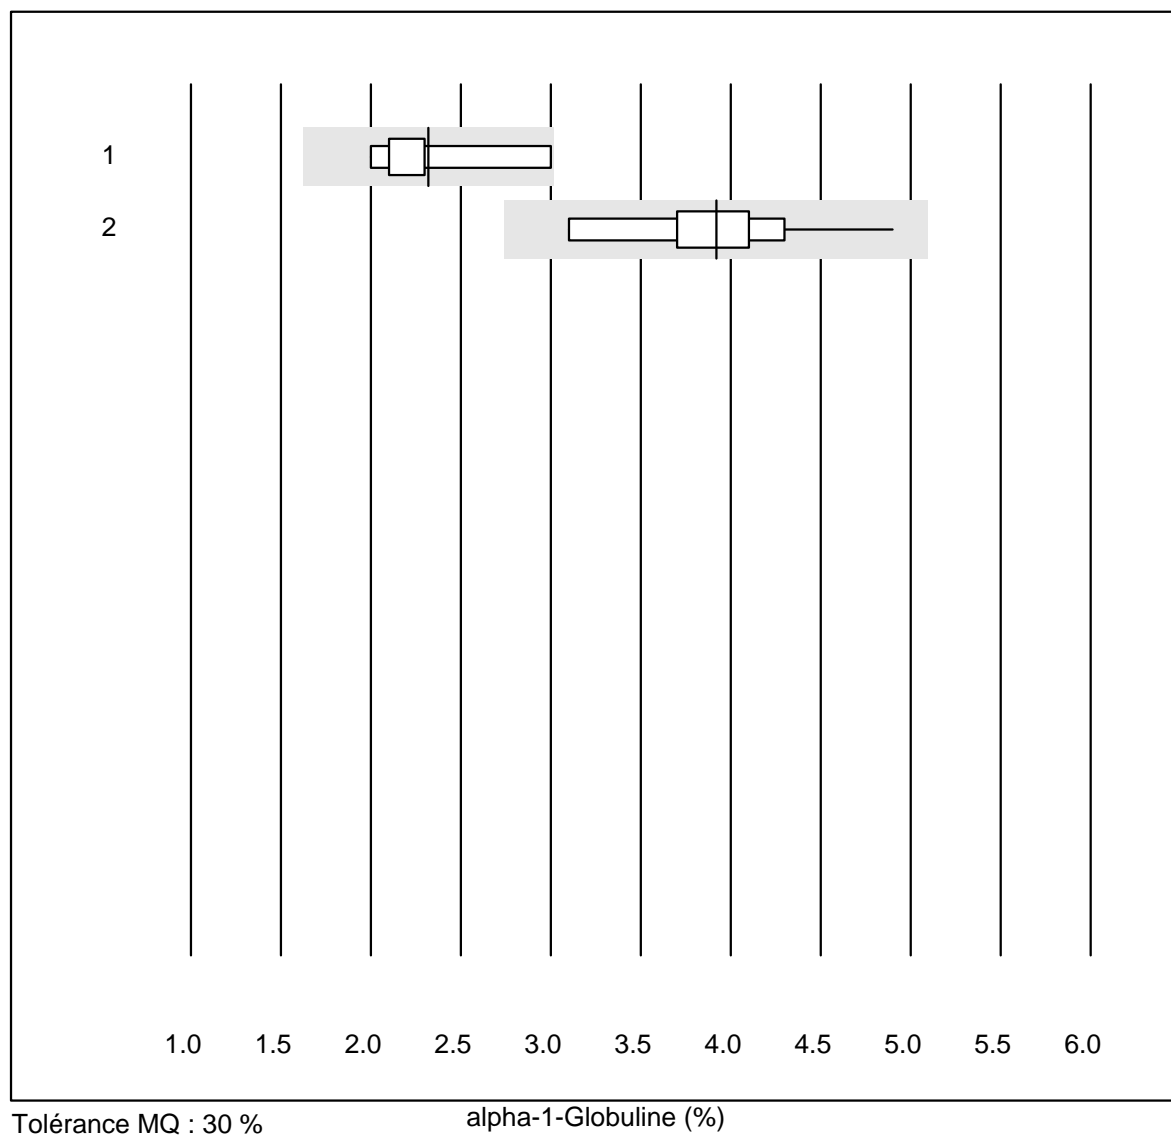


Tolérance MQ : 30 %

alpha-1-Globuline (%)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 électrophorèse	8	100.0	0.0	0.0	2.3	13.1	a
2 électrophorèse capil	10	100.0	0.0	0.0	3.9	12.0	e*

alpha-2-Globuline

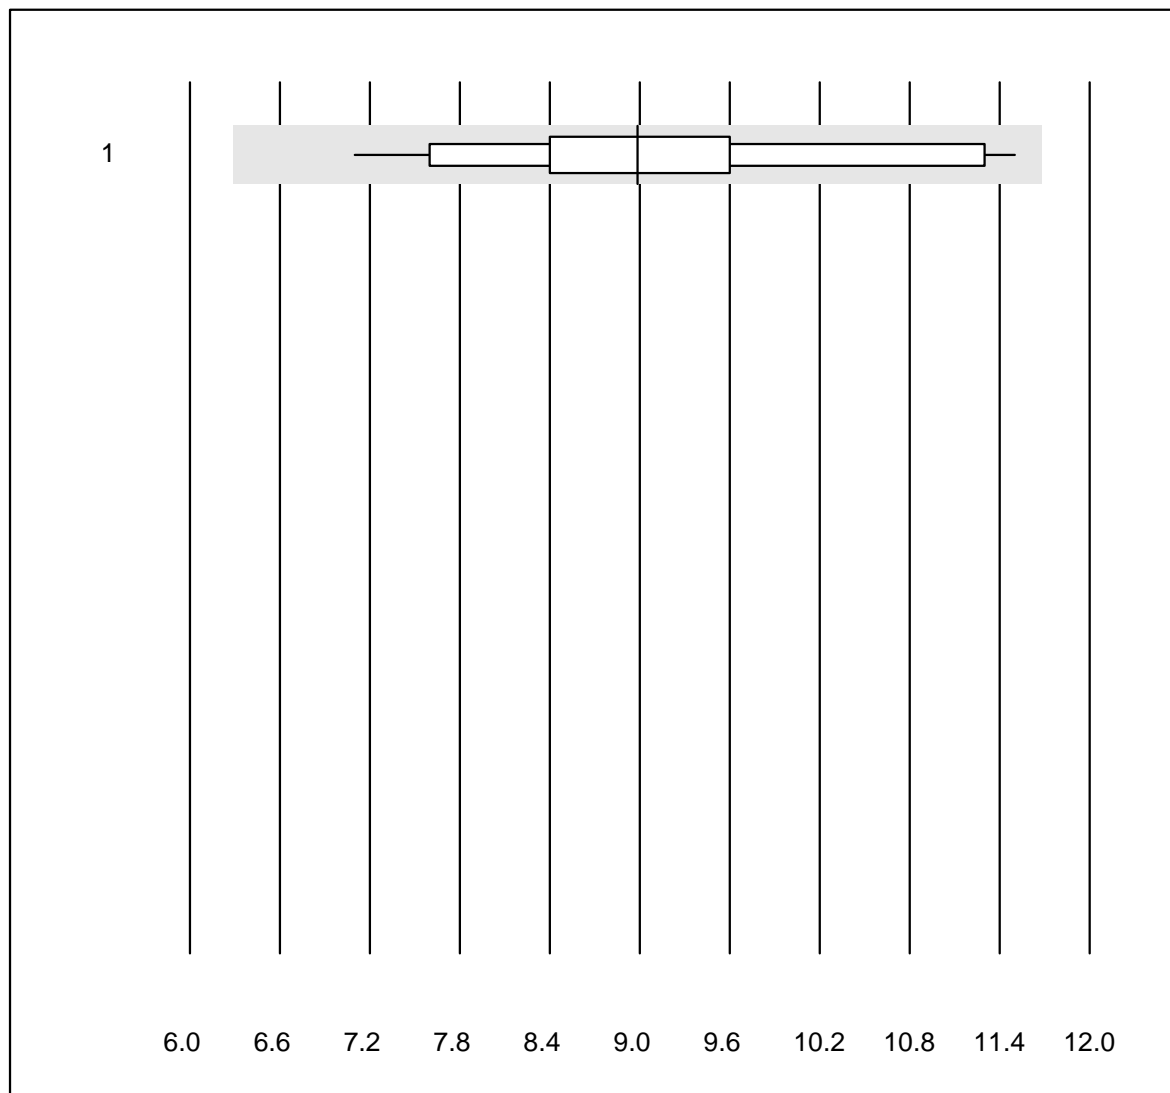


Tolérance MQ : 30 %

alpha-2-Globuline (%)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 électrophorèse	18	100.0	0.0	0.0	9.0	13.0	e

beta-Globuline

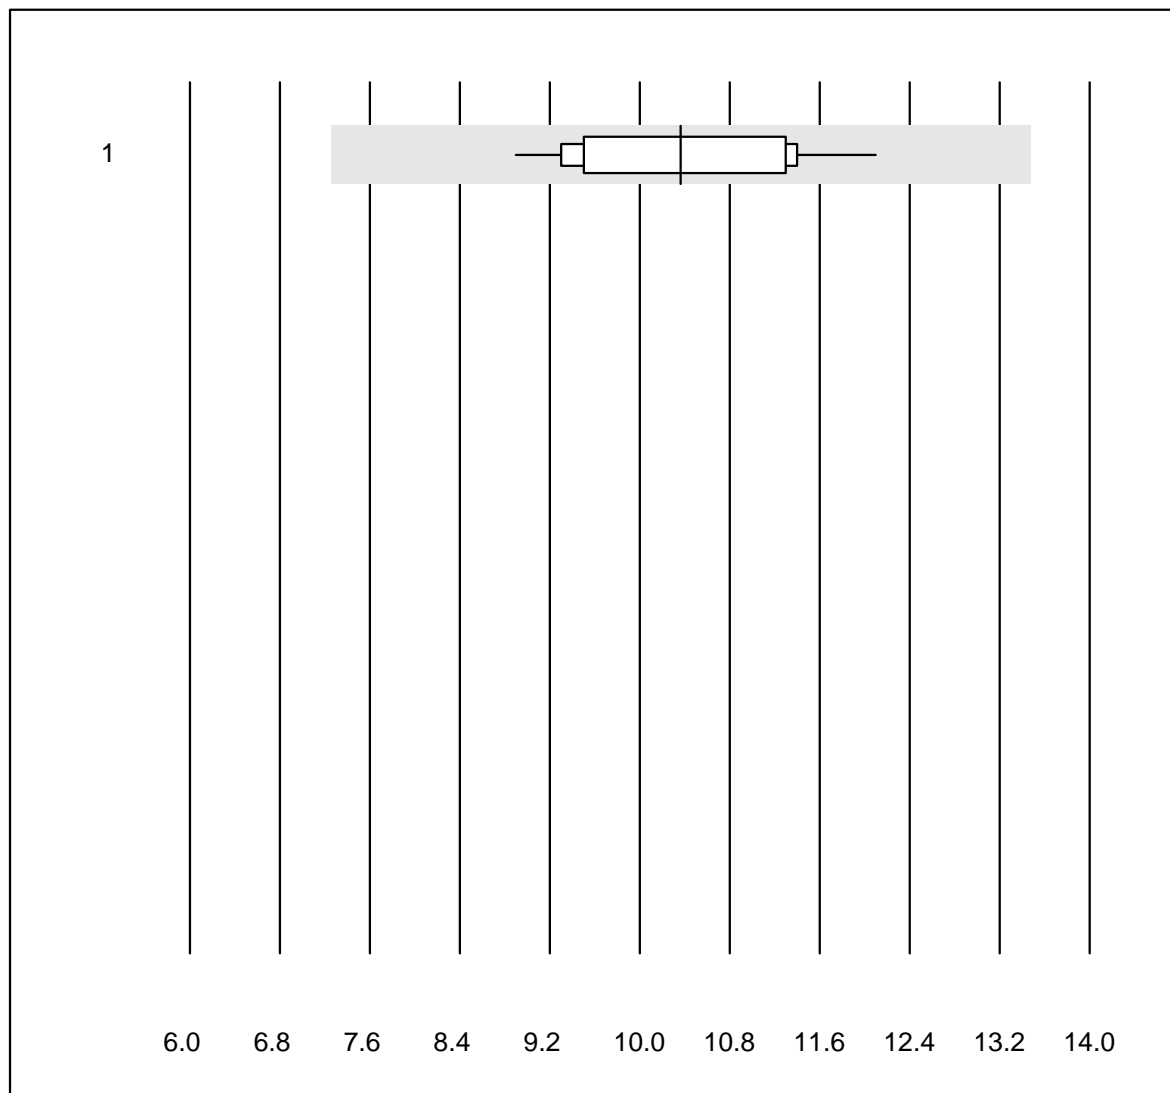


Tolérance MQ : 30 %

beta-Globuline (%)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 électrophorèse	14	100.0	0.0	0.0	10.4	9.2	e

Beta-1-Globulin

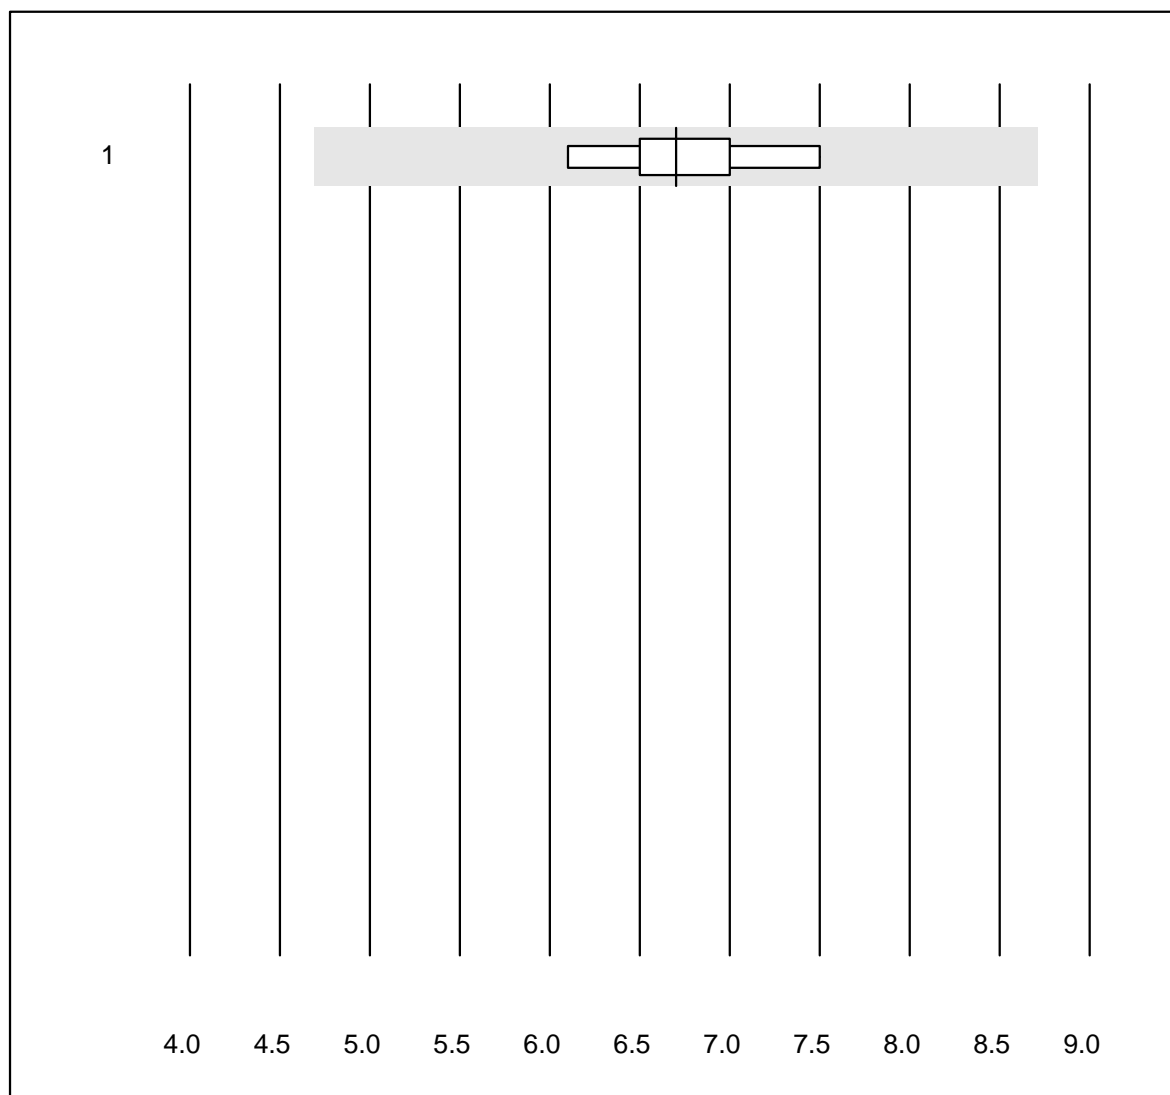


Tolérance MQ : 30 %

Beta-1-Globulin (%)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 électrophorèse	6	100.0	0.0	0.0	6.7	7.1	e

Beta-2-Globulin

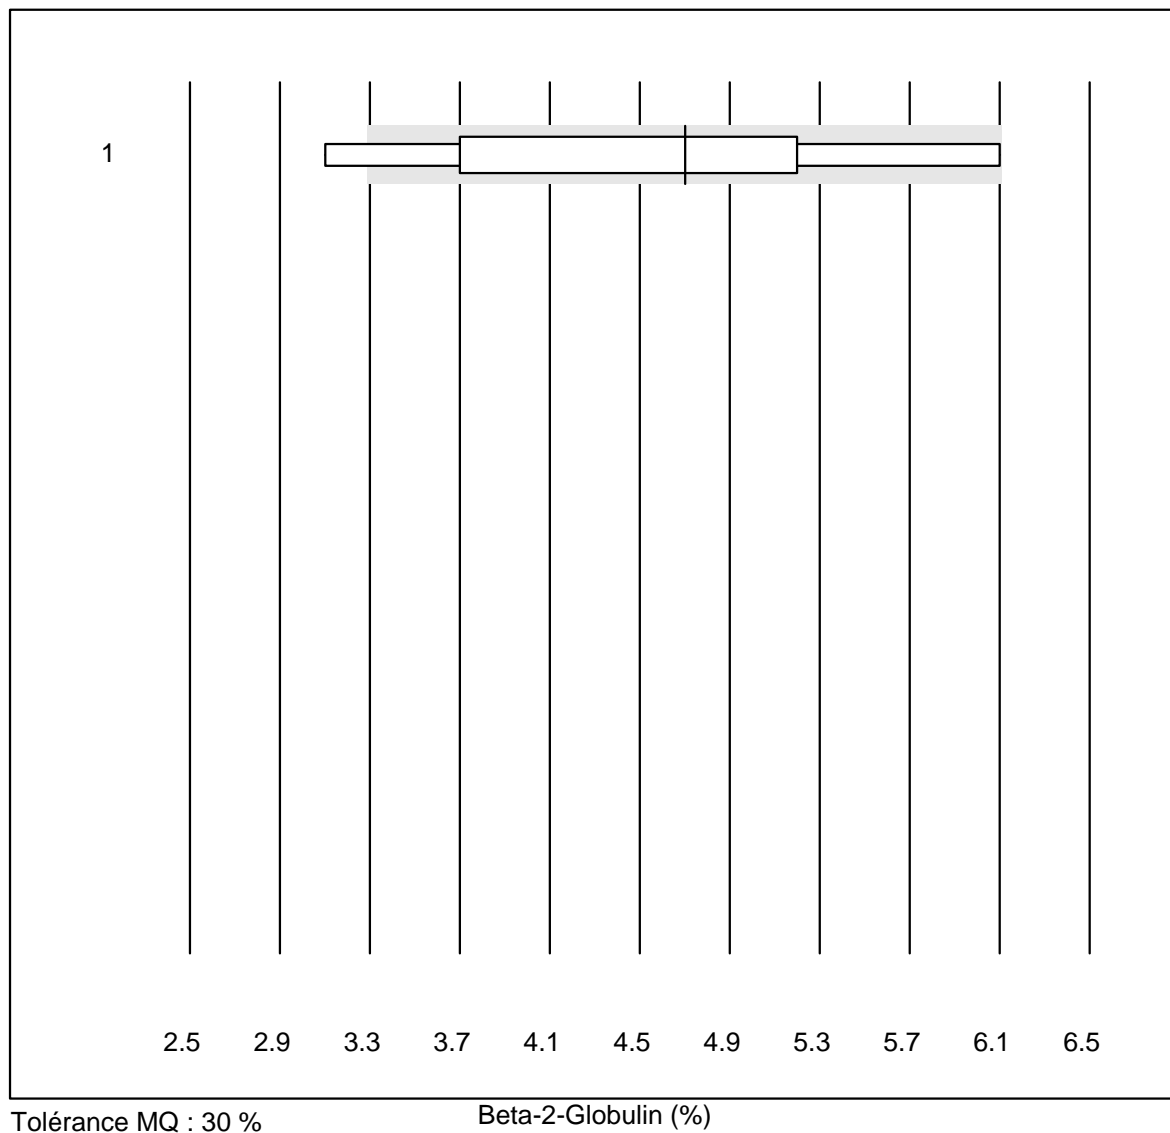

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 électrophorèse	7	85.7	14.3	0.0	4.7	21.2	a

gamma-Globuline

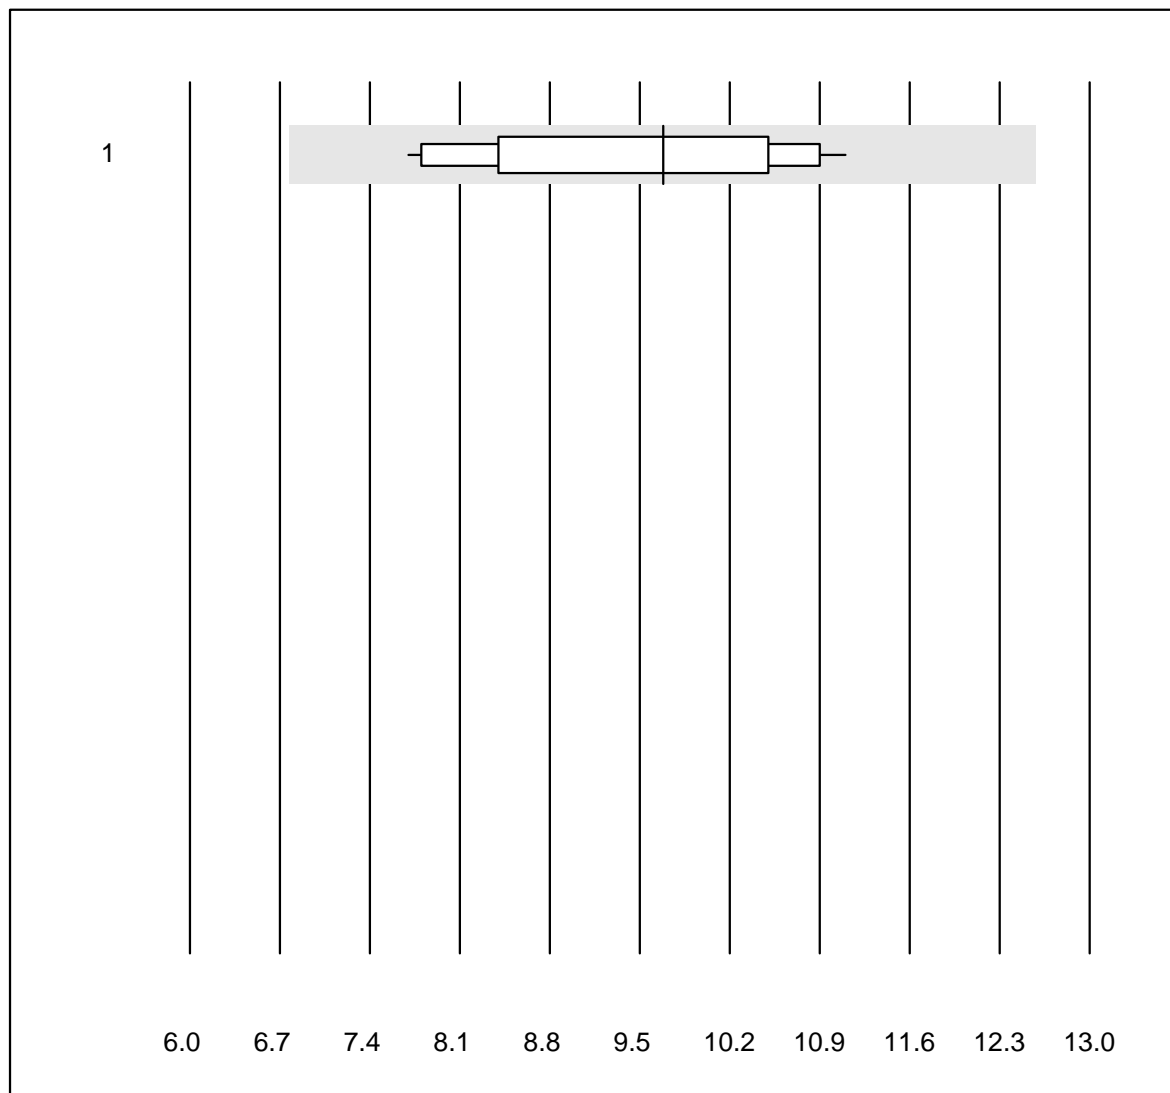


Tolérance MQ : 30 %

gamma-Globuline (%)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 électrophorèse	15	100.0	0.0	0.0	9.7	12.4	e

Gamma-Globuline+P

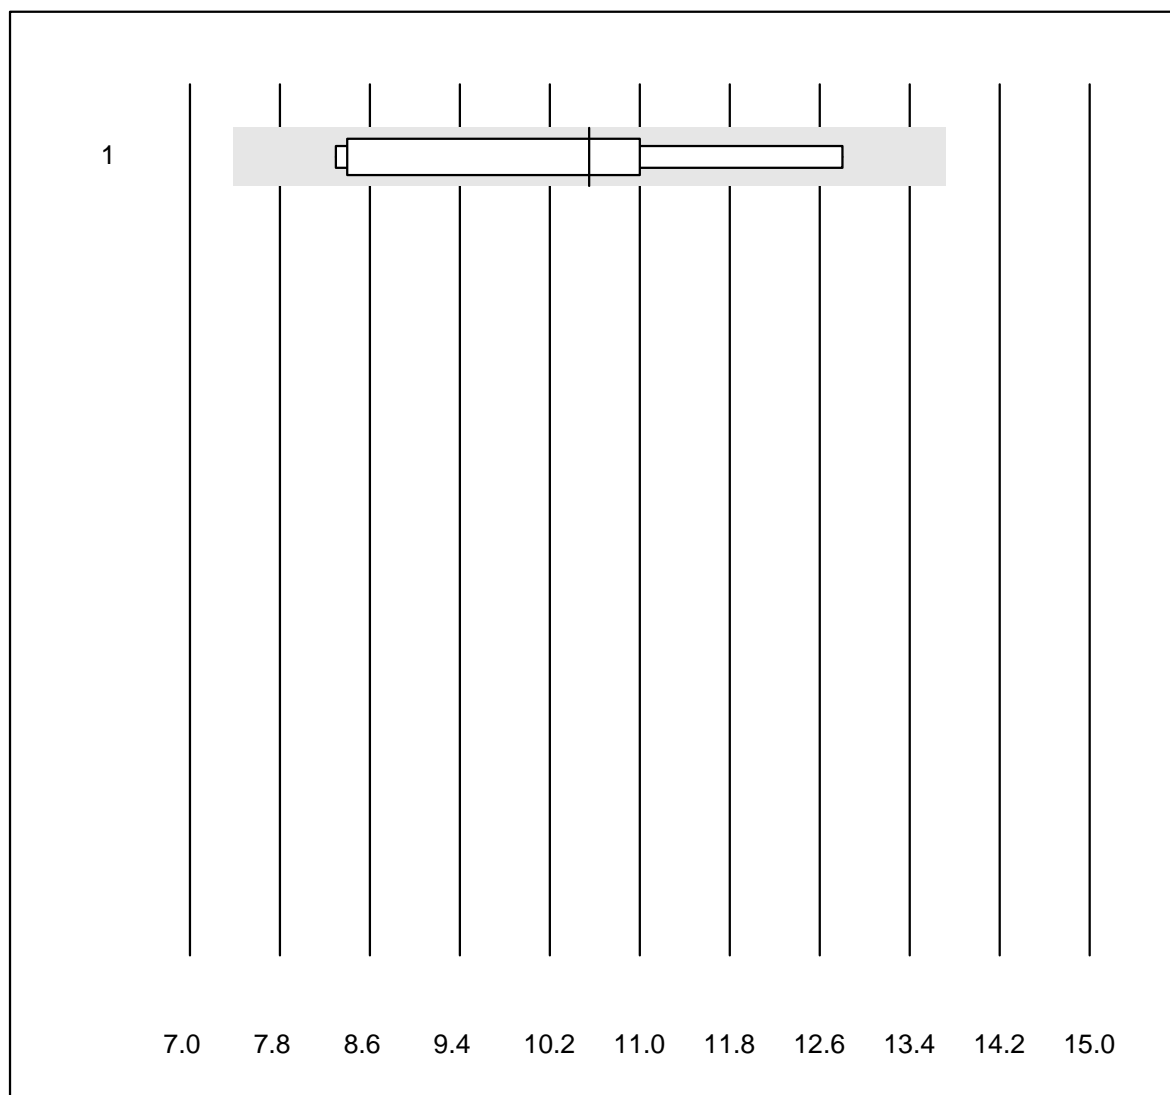


Tolérance MQ : 30 %

Gamma-Globuline+P (%)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 électrophorèse	5	100.0	0.0	0.0	10.6	19.6	a

Immunfixation

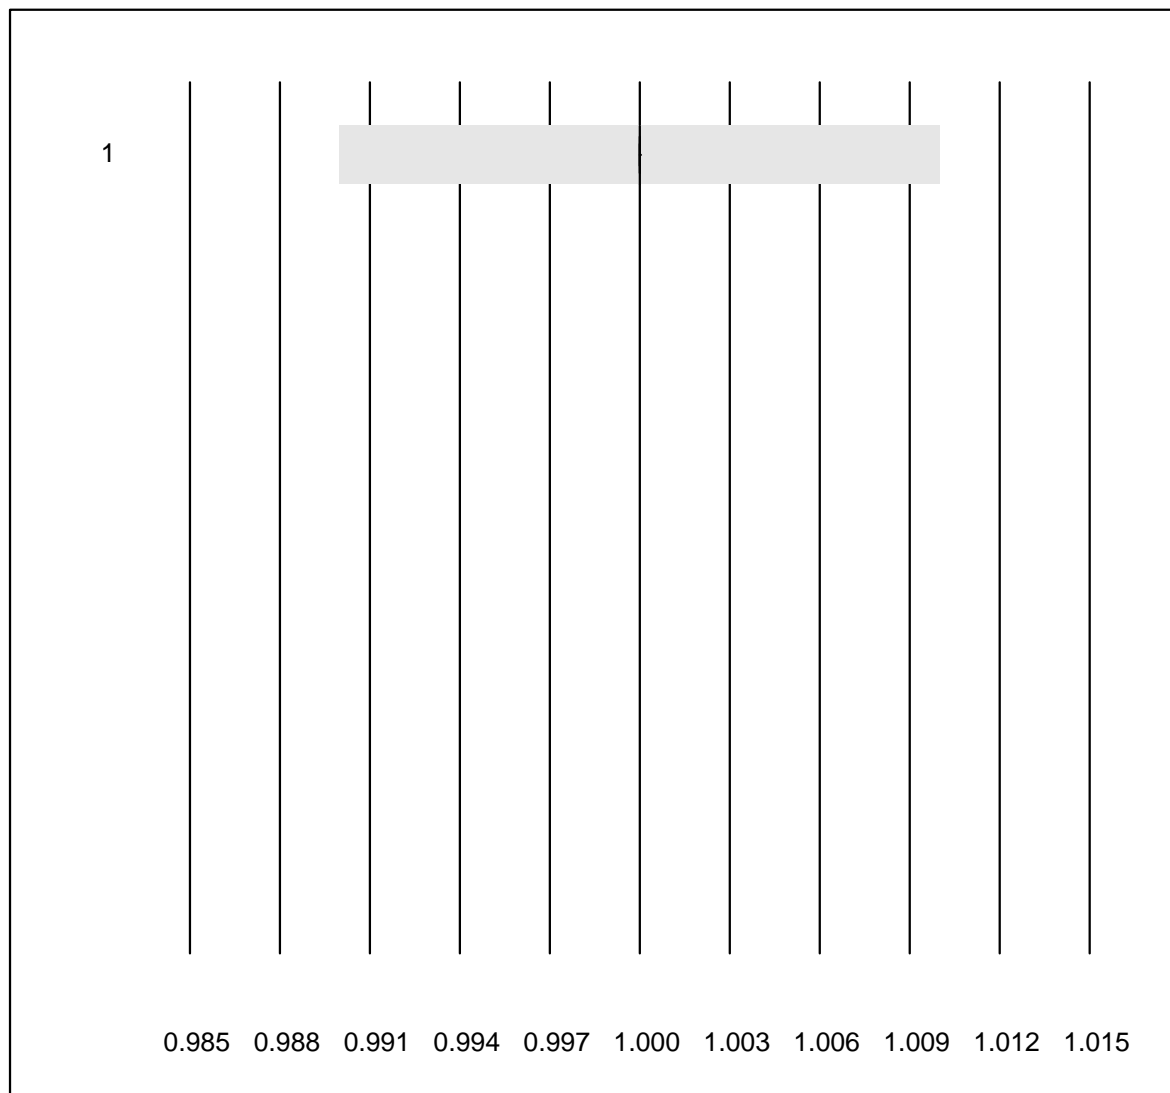


QUALAB Tolérance : 1 %

Immunfixation (Code)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 interprétation	17	100.0	0.0	0.0	1	0.0	e

Folates érythrocytaires

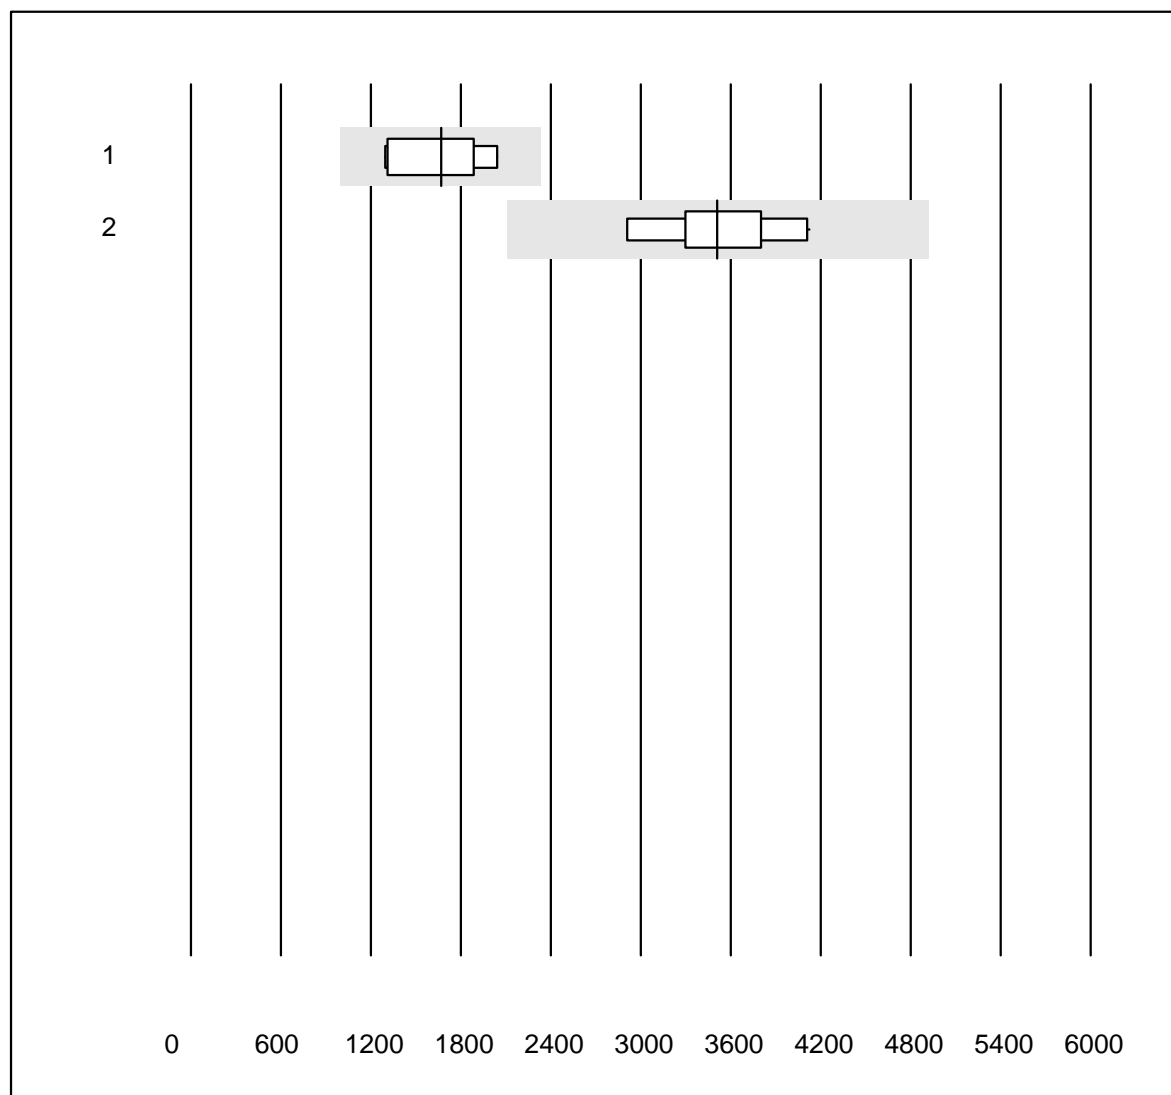


Tolérance MQ : 40 %

Folates érythrocytaires (nmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Alinity	6	100.0	0.0	0.0	1668	18.8	a
2 Cobas	10	100.0	0.0	0.0	3512	12.3	e

Gallensäure

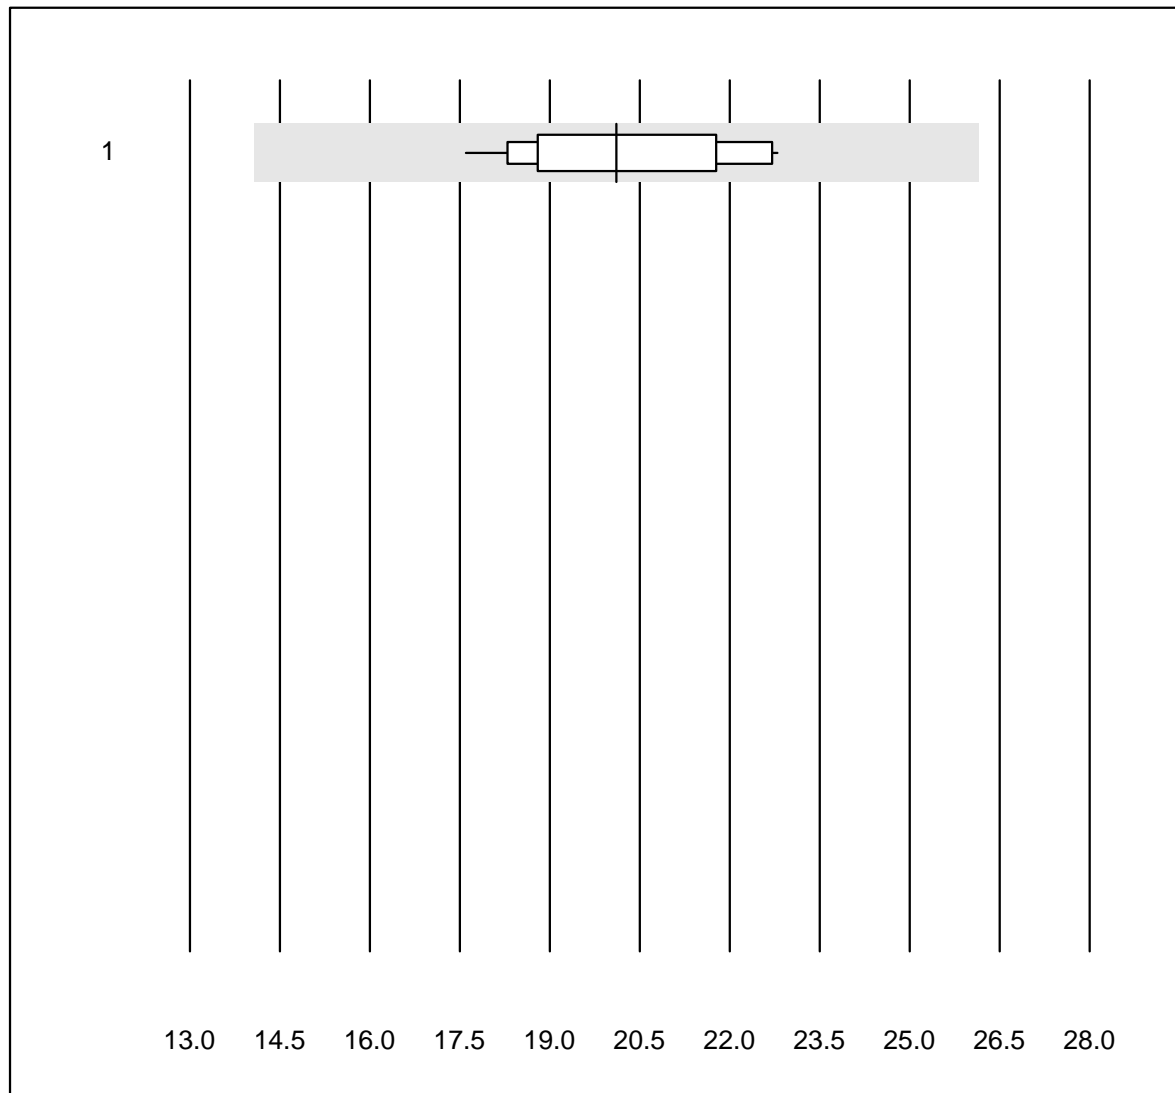


Tolérance MQ : 30 %

Gallensäure (µmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	13	100.0	0.0	0.0	20.1	9.1	e

BNP

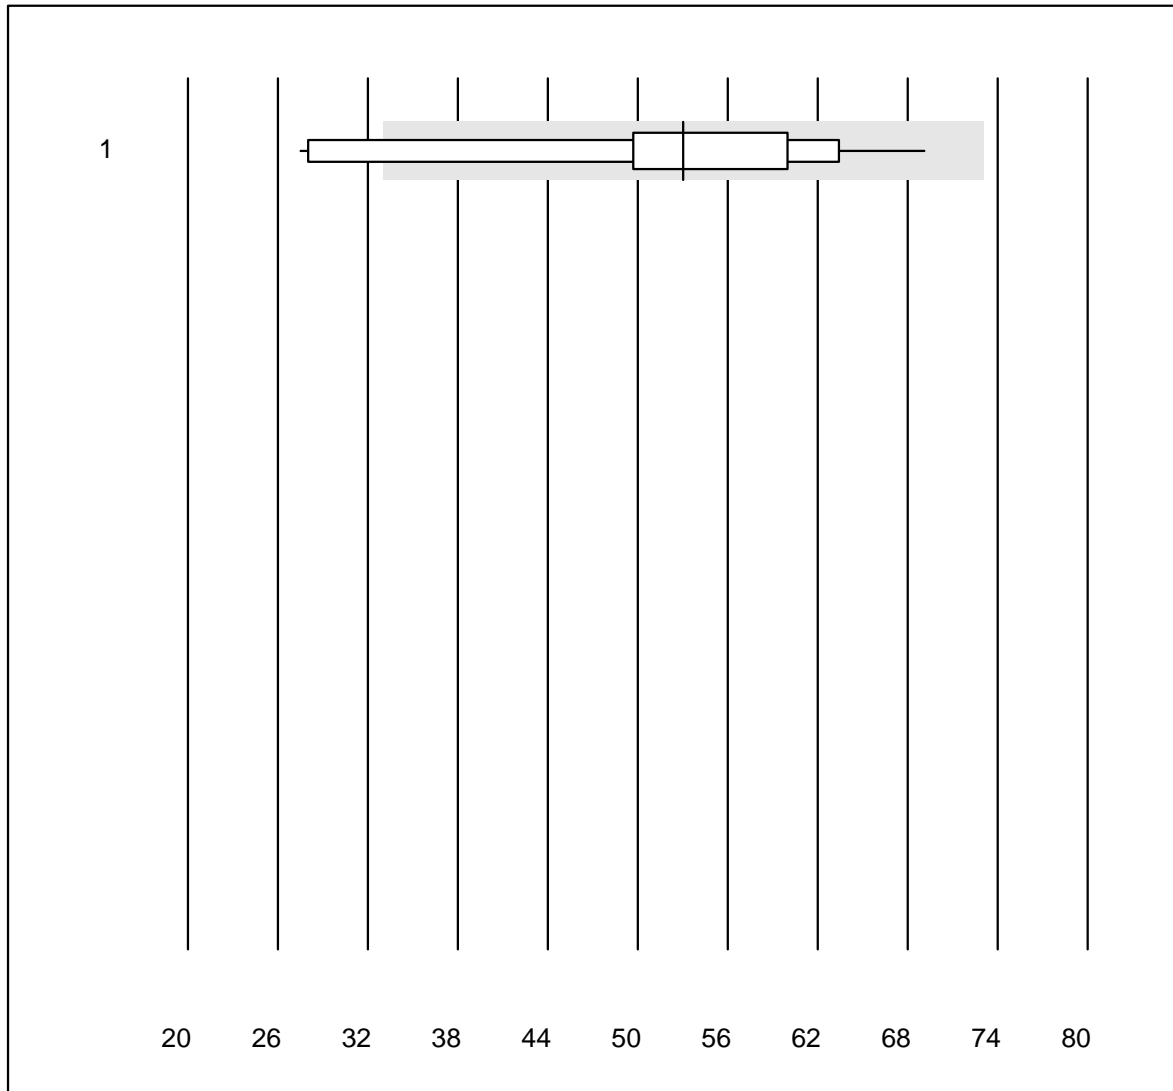


QUALAB Tolérance : 27 %
(< 75.0: +/- 20.0 ng/l)

BNP (ng/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Triage	20	90.0	10.0	0.0	53.0	21.0	e*

Troponin Triage

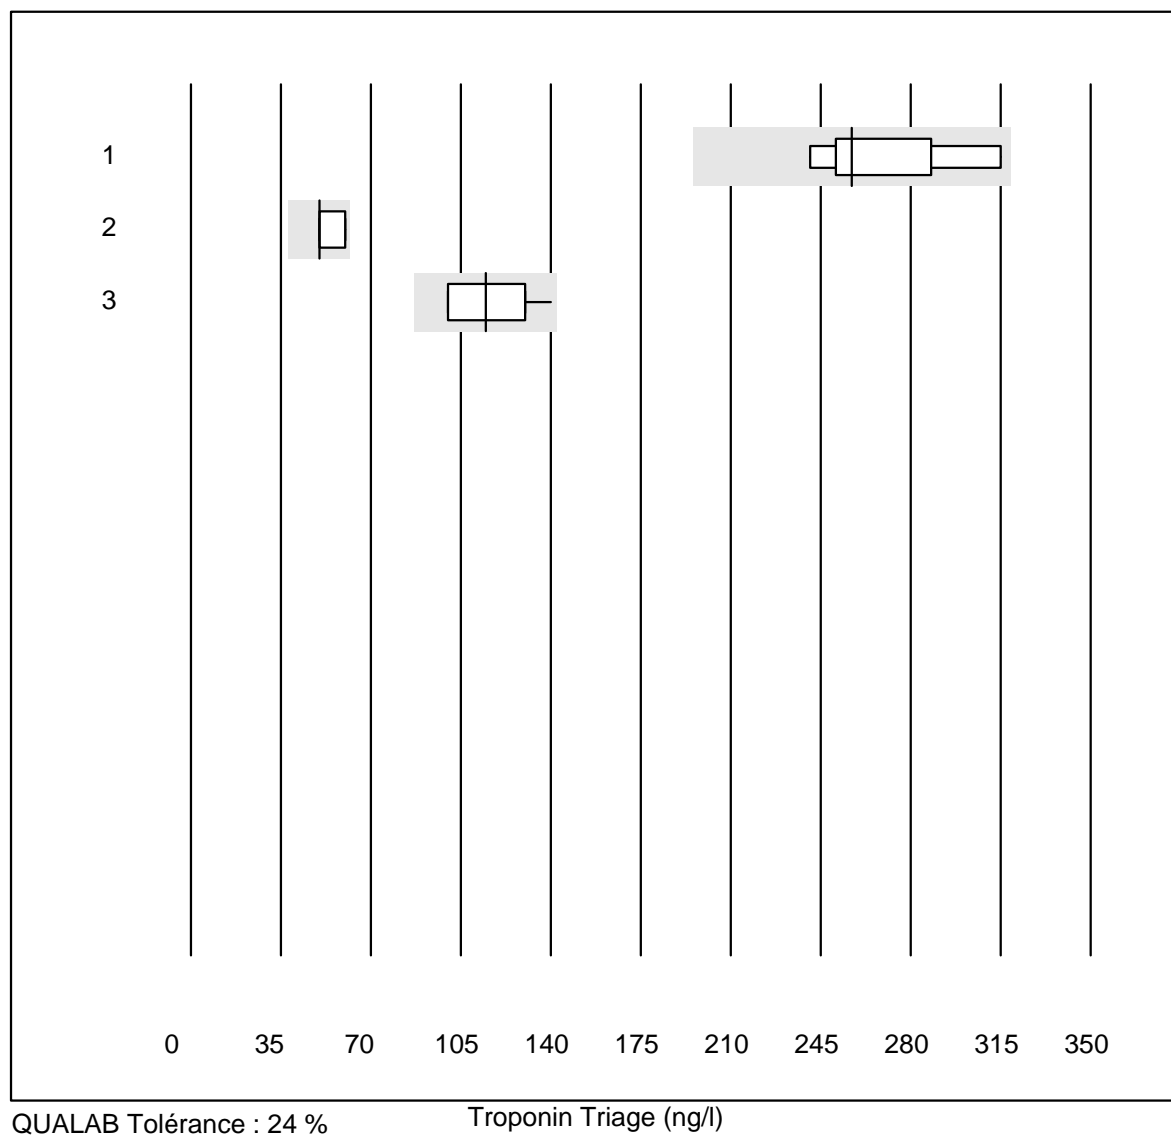


QUALAB Tolérance : 24 %

Troponin Triage (ng/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Triage high sensitiv	9	100.0	0.0	0.0	257.00	10.4	e*
2 Triage SOB/Cardiac	7	100.0	0.0	0.0	50.00	9.2	e*
3 Triage Next Gen	17	100.0	0.0	0.0	114.71	12.0	e*

NT-pro BNP

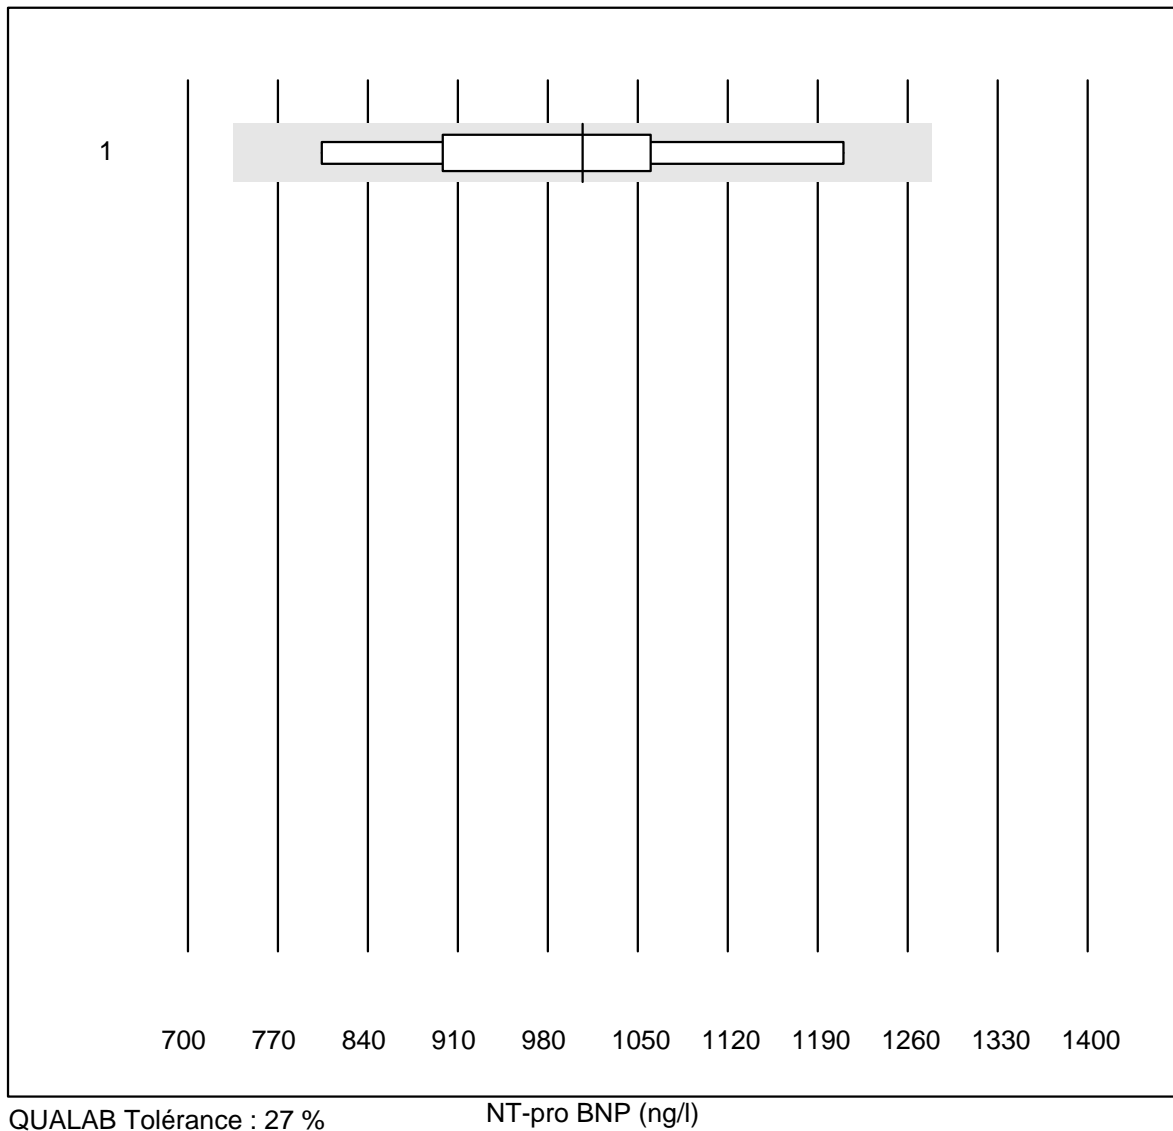


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Triage	9	100.0	0.0	0.0	1007	13.1	a

D-Dimere Triage

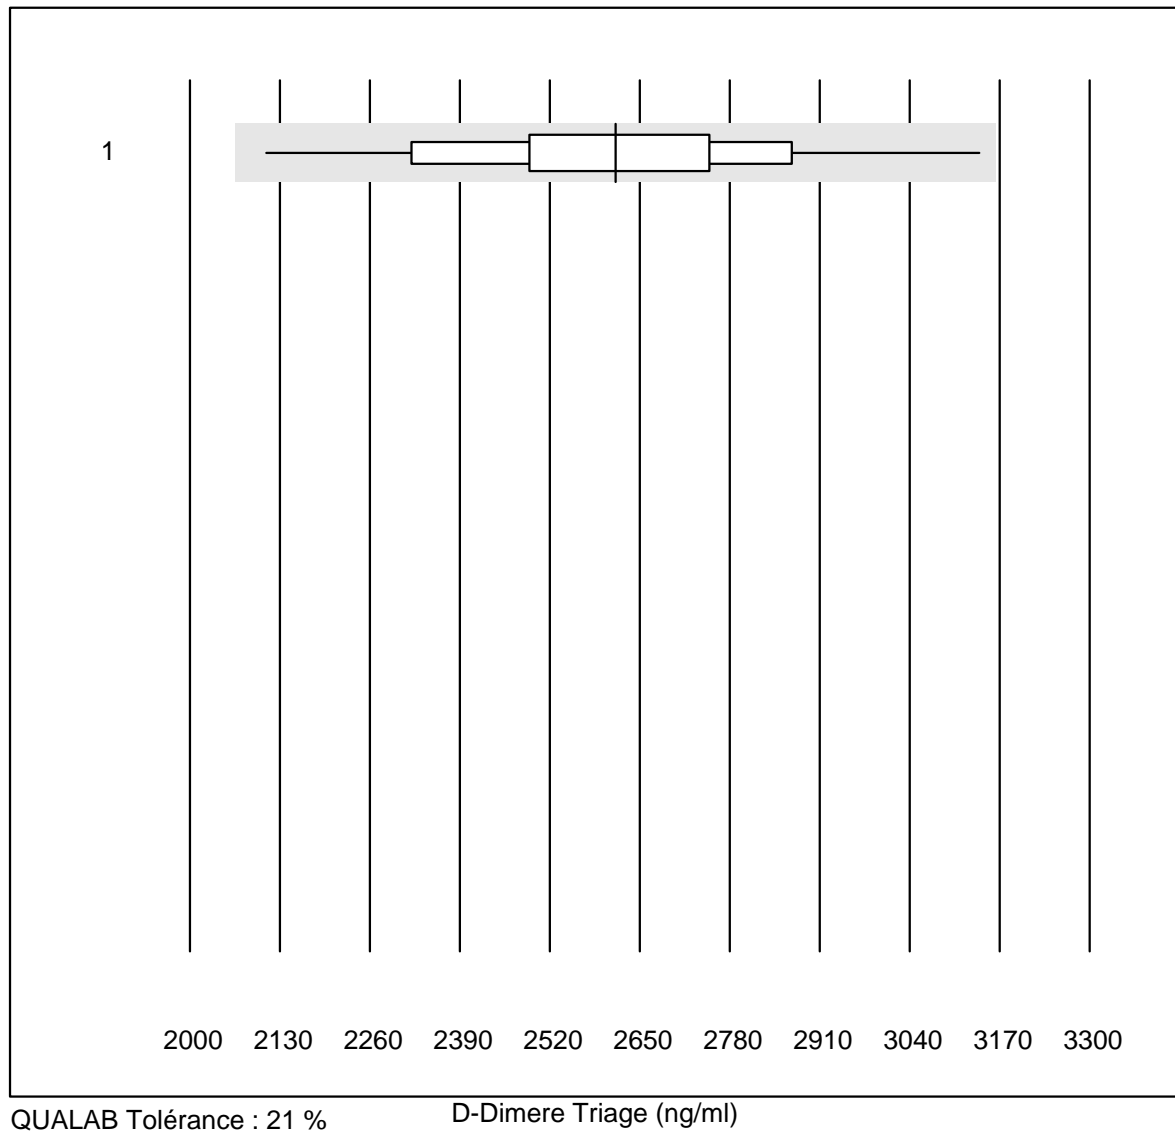

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Triage	33	100.0	0.0	0.0	2615.15	8.6	e

CK-MB Triage

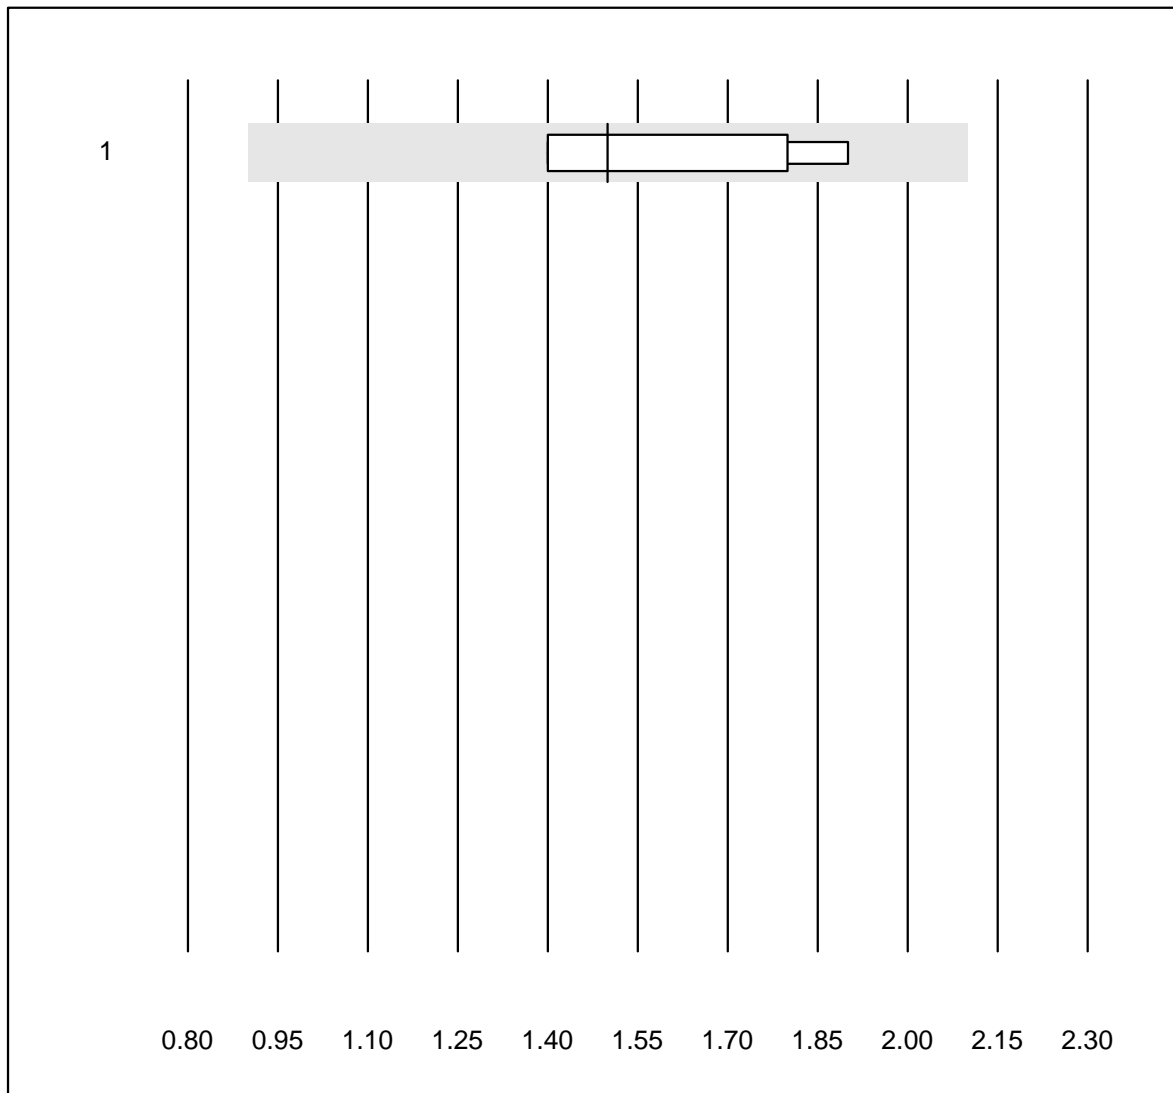


Tolérance MQ : 40 %

CK-MB Triage (µg/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Triage	6	100.0	0.0	0.0	1.5	13.5	e*

Myoglobin Triage

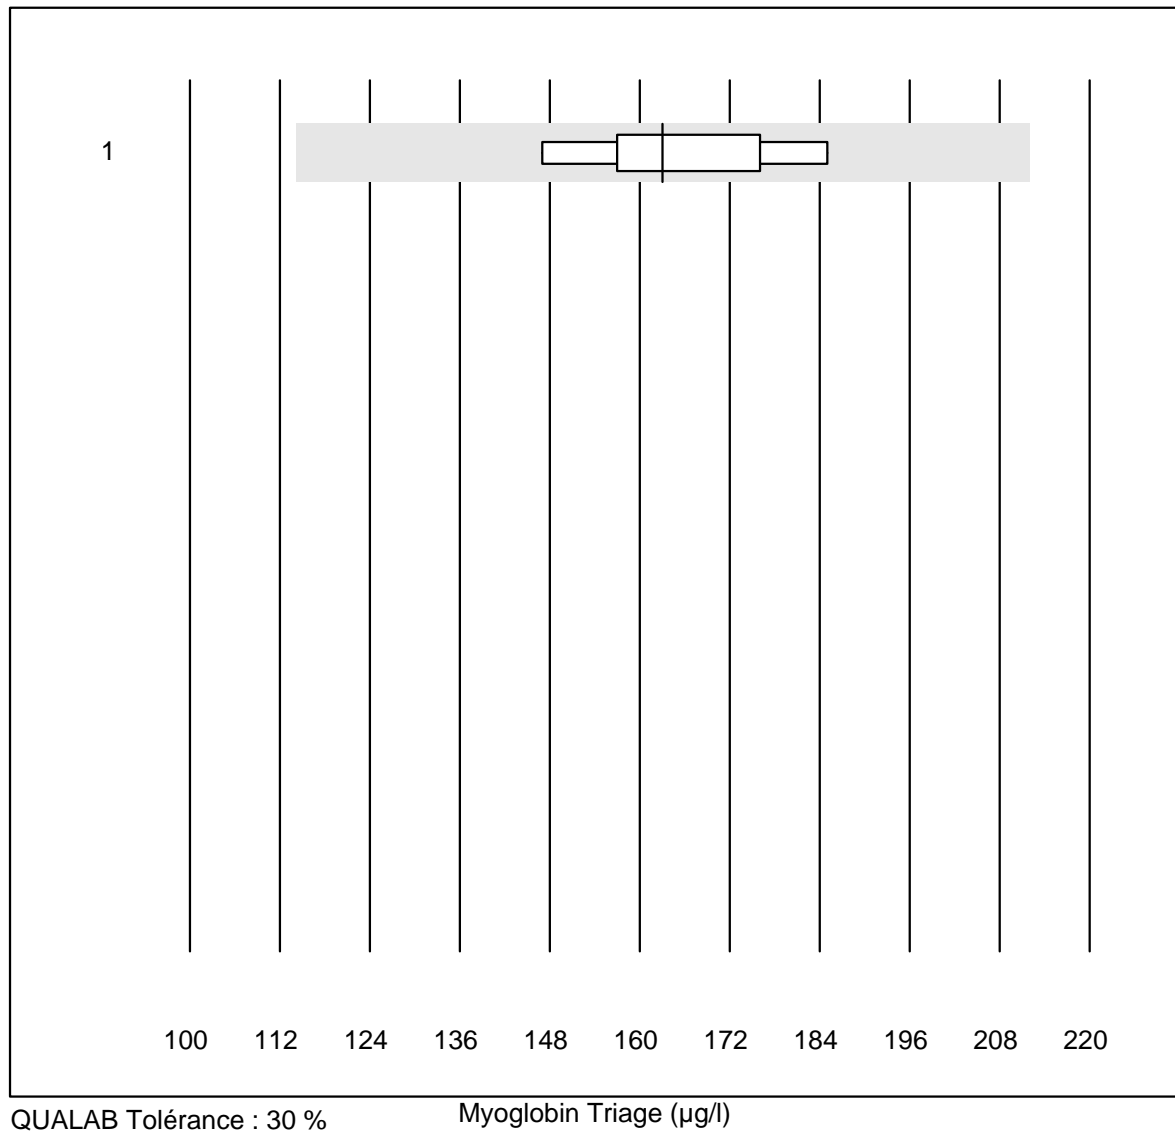


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Triage	6	83.3	0.0	16.7	163.0	9.0	e*

Vitamine D 25 (OH)

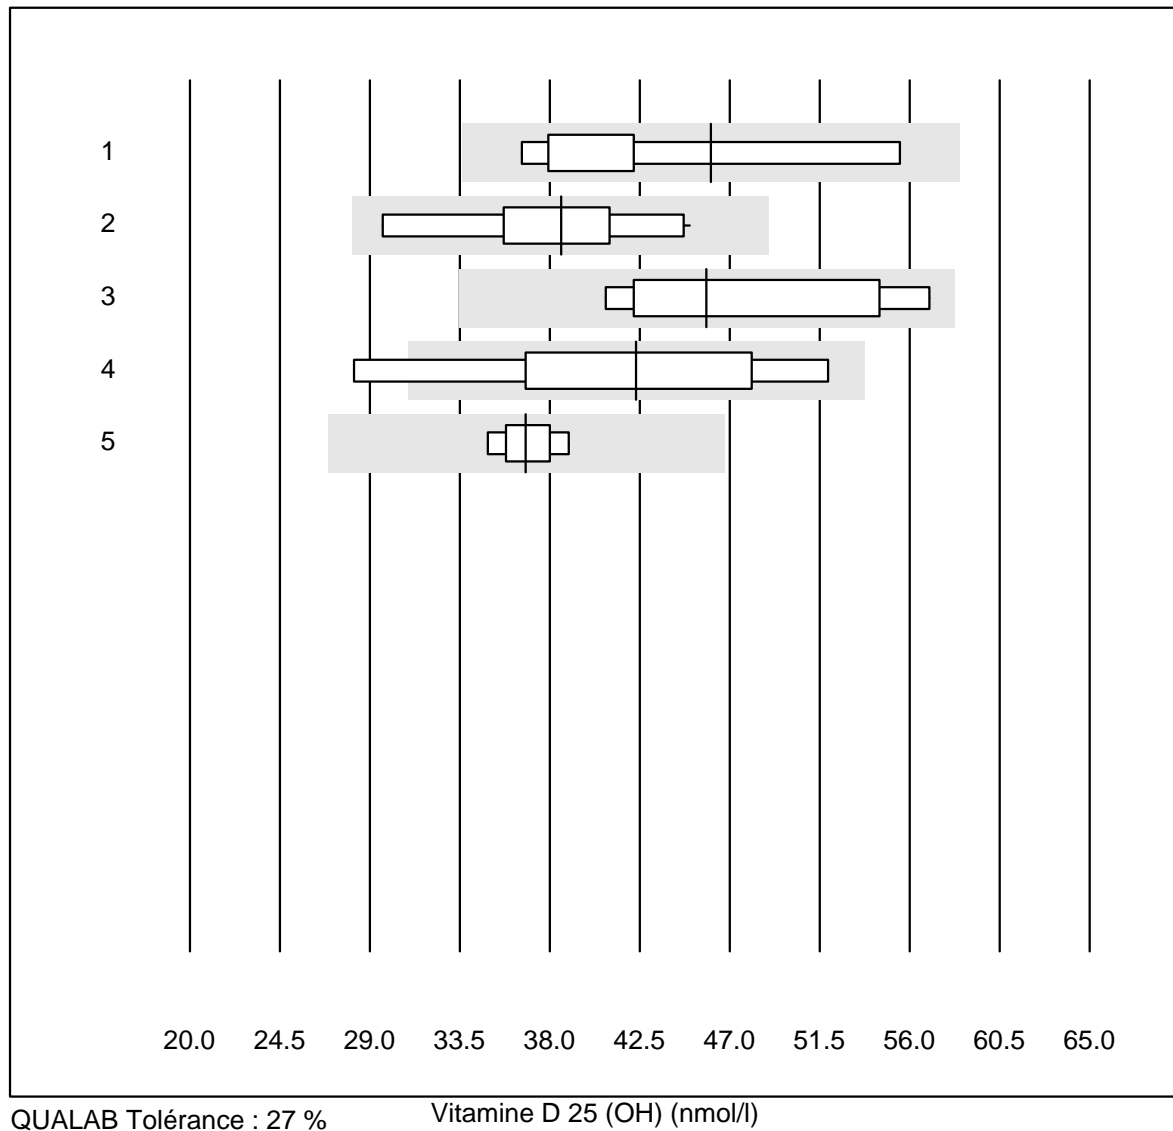

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 LCMS	5	100.0	0.0	0.0	46.1	18.2	a
2 Cobas	10	100.0	0.0	0.0	38.6	12.2	e*
3 VIDAS	6	100.0	0.0	0.0	45.8	14.0	e*
4 Autres méthodes	9	77.8	11.1	11.1	42.3	18.1	e*
5 Architect	9	100.0	0.0	0.0	36.8	3.8	e

AMH

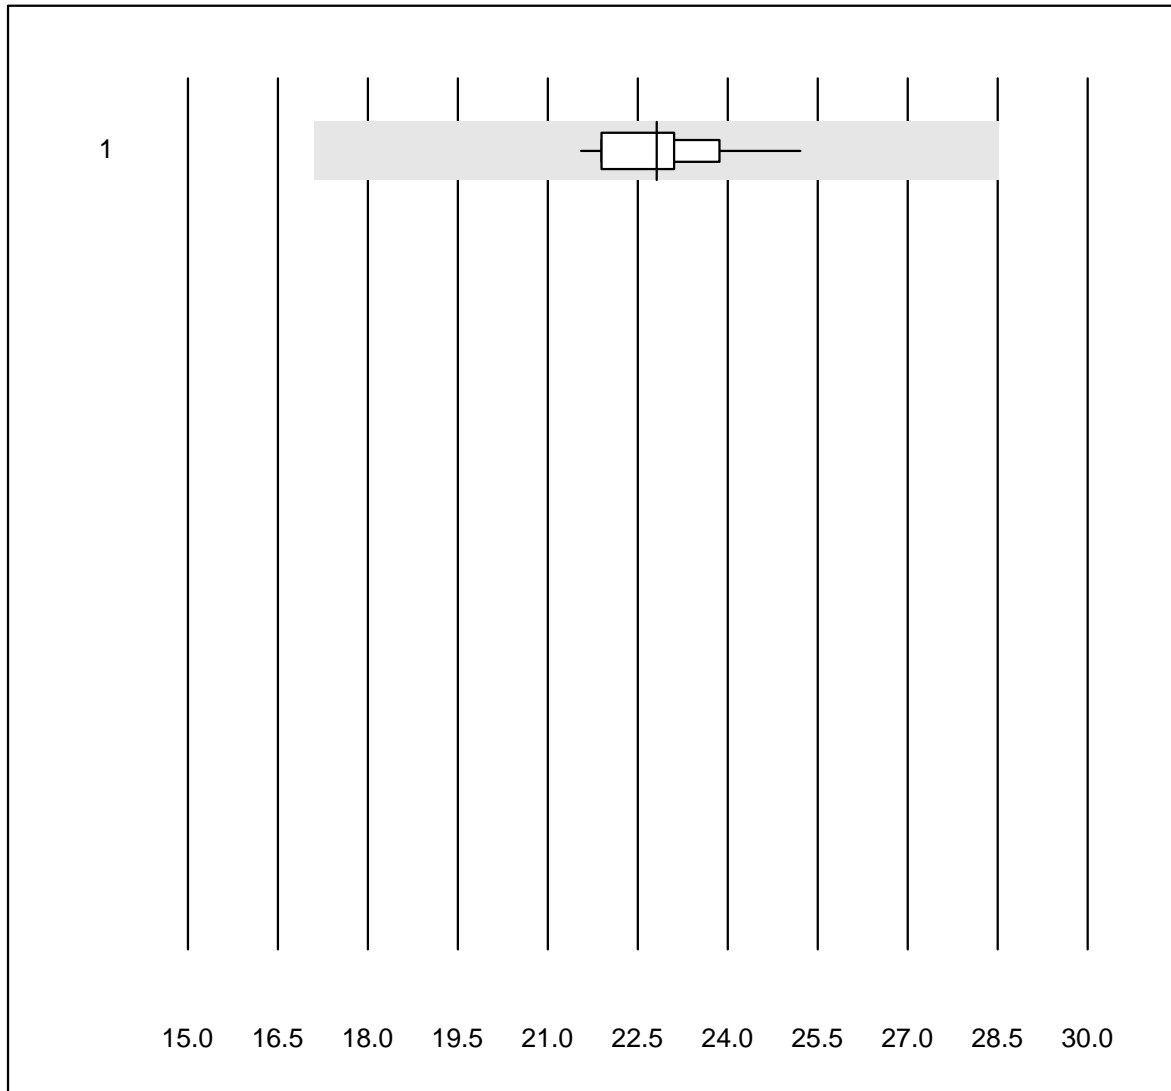


Tolérance MQ : 25 %

AMH (pmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	12	100.0	0.0	0.0	22.8	4.7	e


Calcitonin

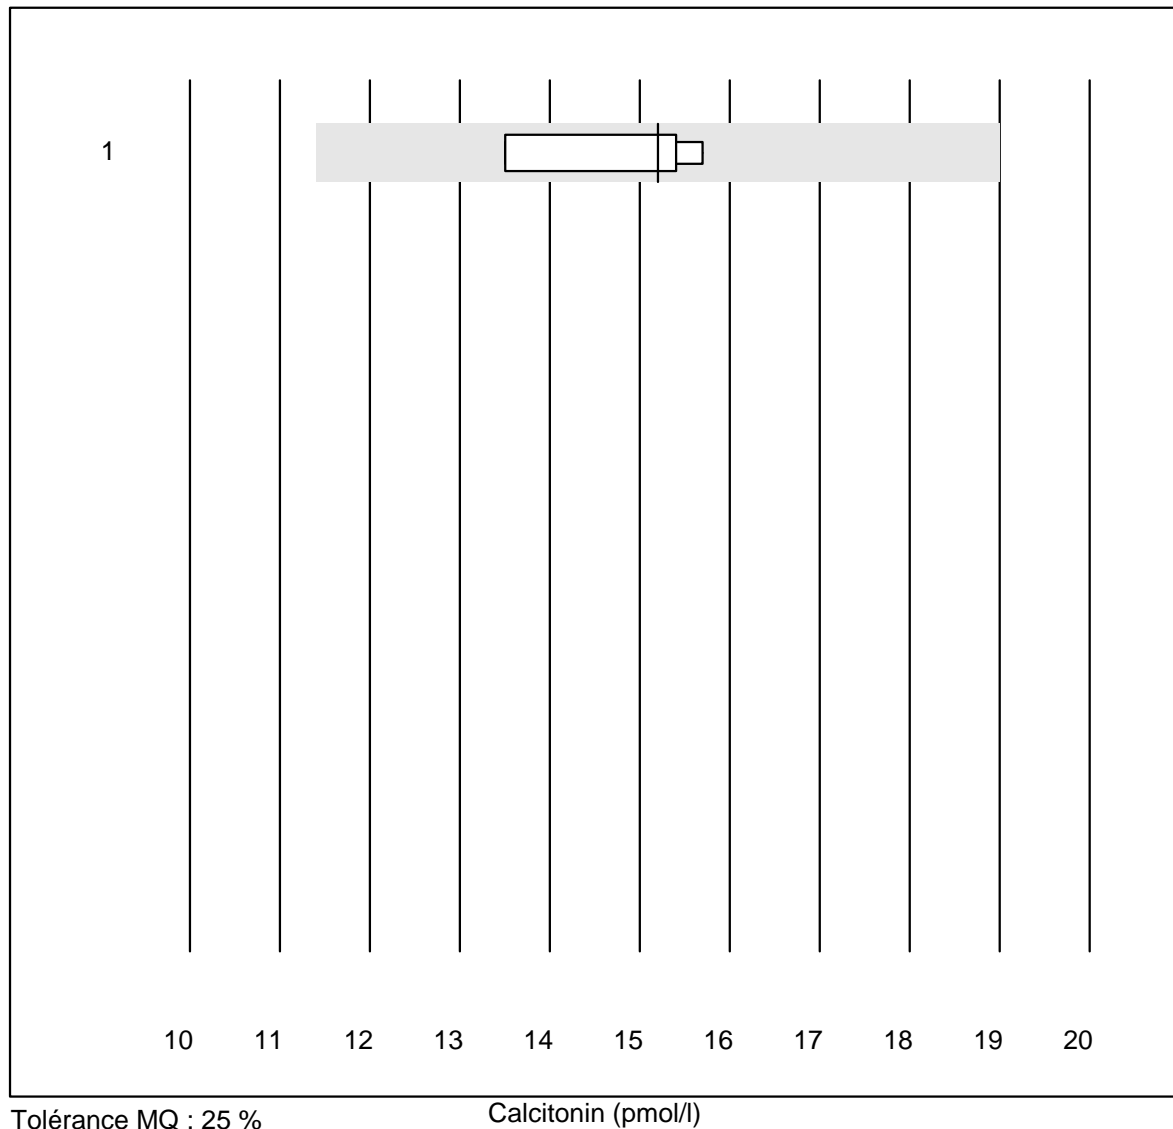

Tolérance MQ : 25 %

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	15.2	6.6	e*

IGF-BP3

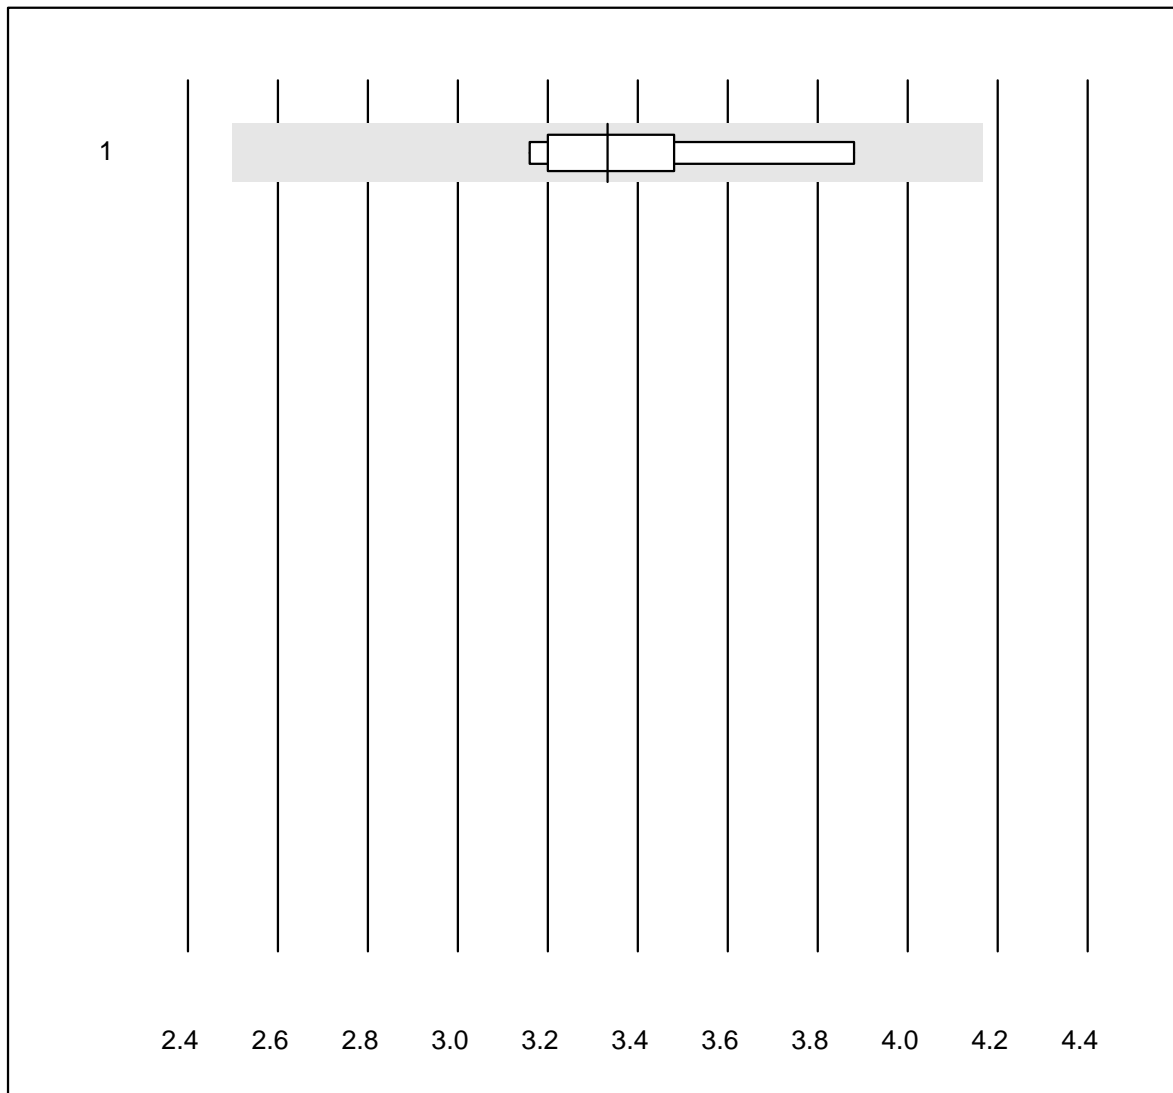


Tolérance MQ : 25 %

IGF-BP3 (mg/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	3.33	8.5	e*

Anti Thyreoglobulin

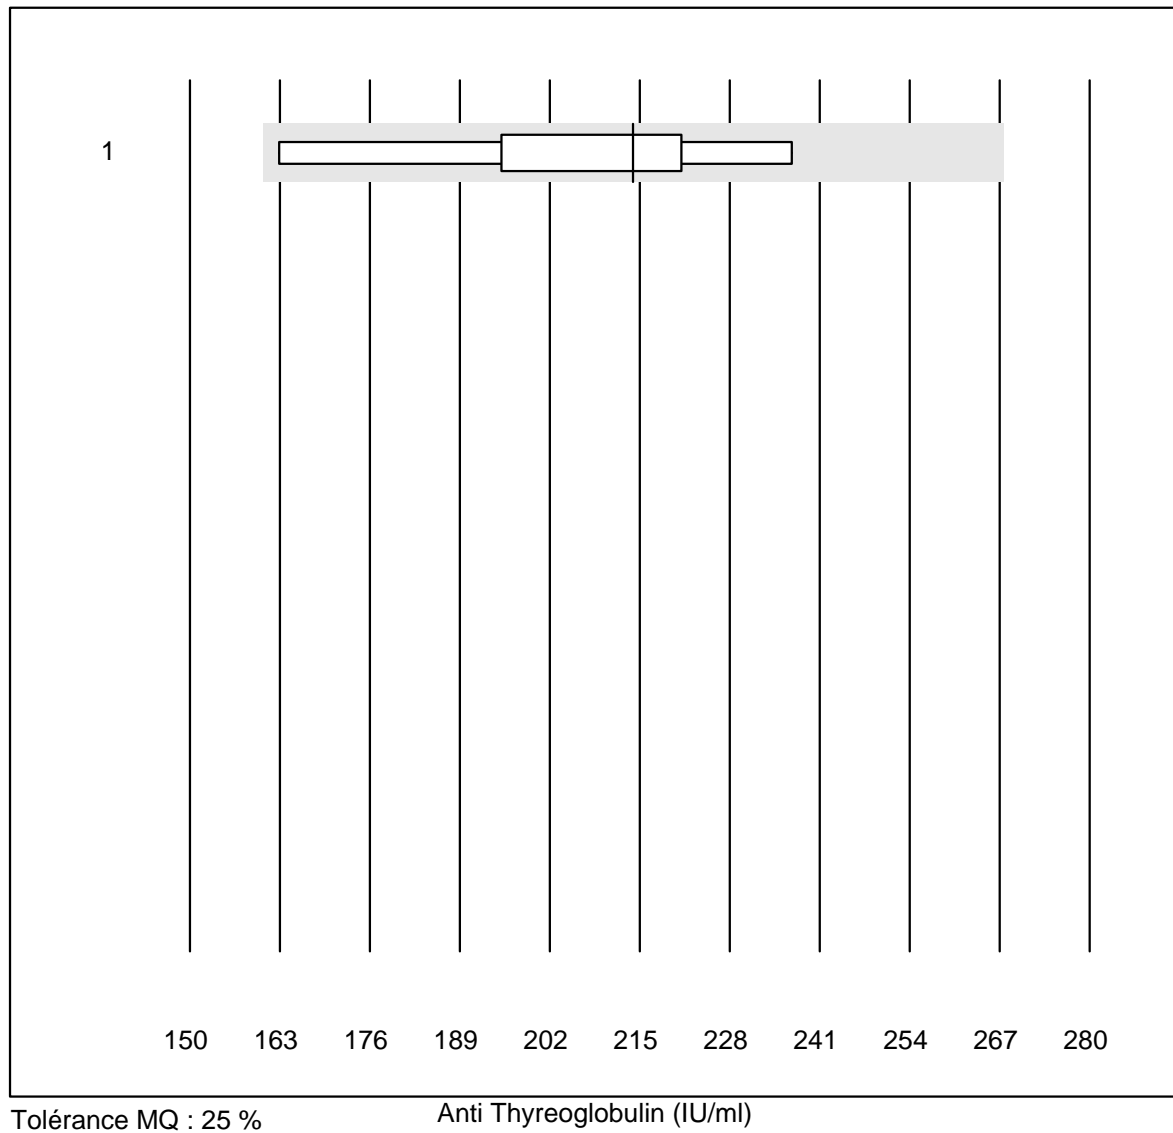

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas	9	100.0	0.0	0.0	214	10.6	e*

Anti TPO

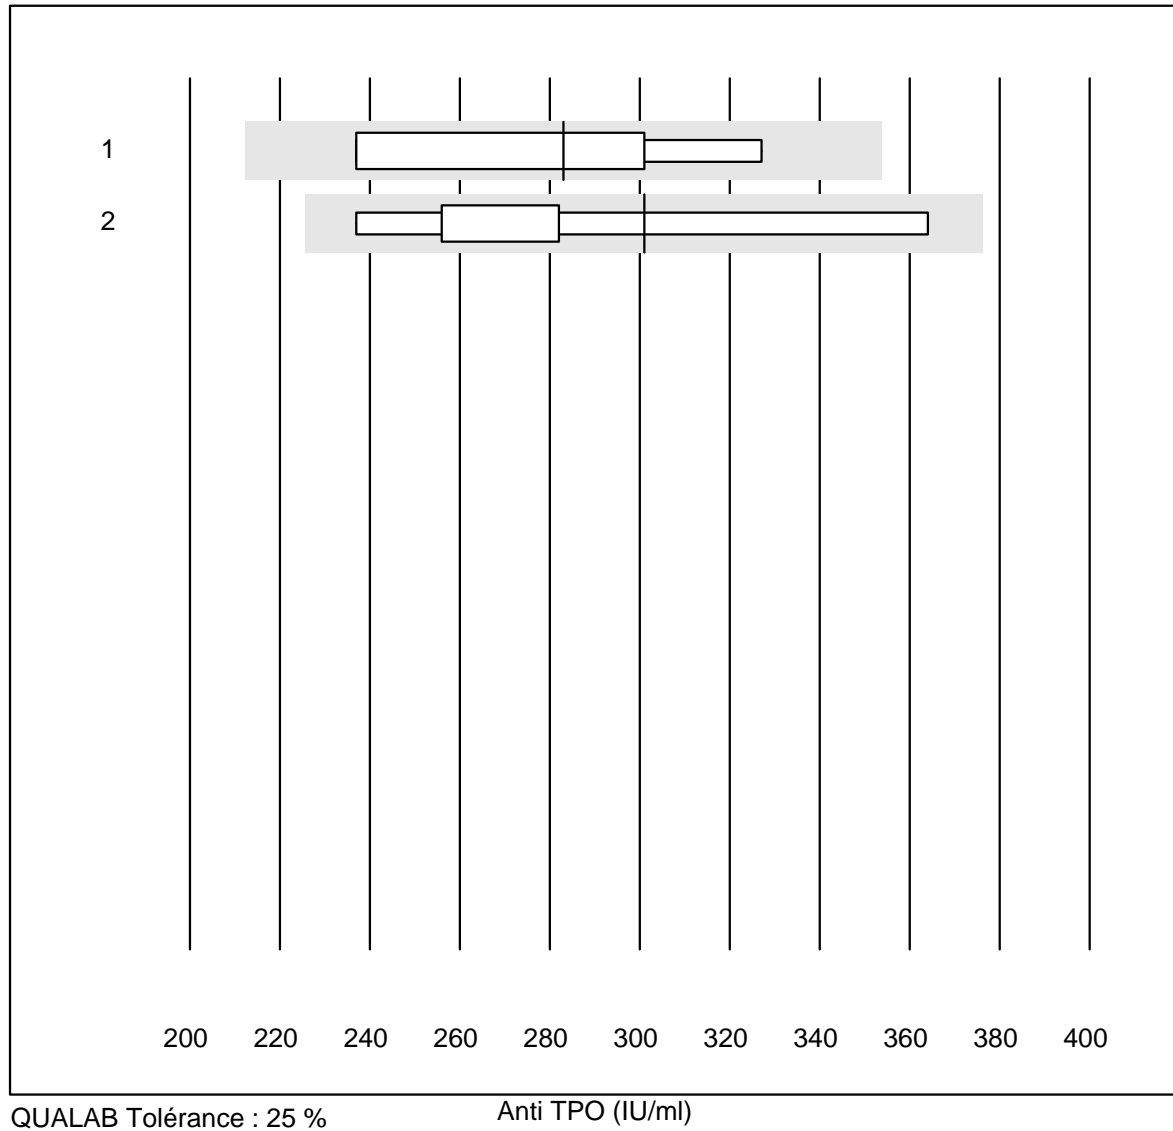


QUALAB Tolérance : 25 %

Anti TPO (IU/ml)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Phadia	4	100.0	0.0	0.0	283	14.0	e*
2 Cobas	9	100.0	0.0	0.0	301	14.1	a

TRAK

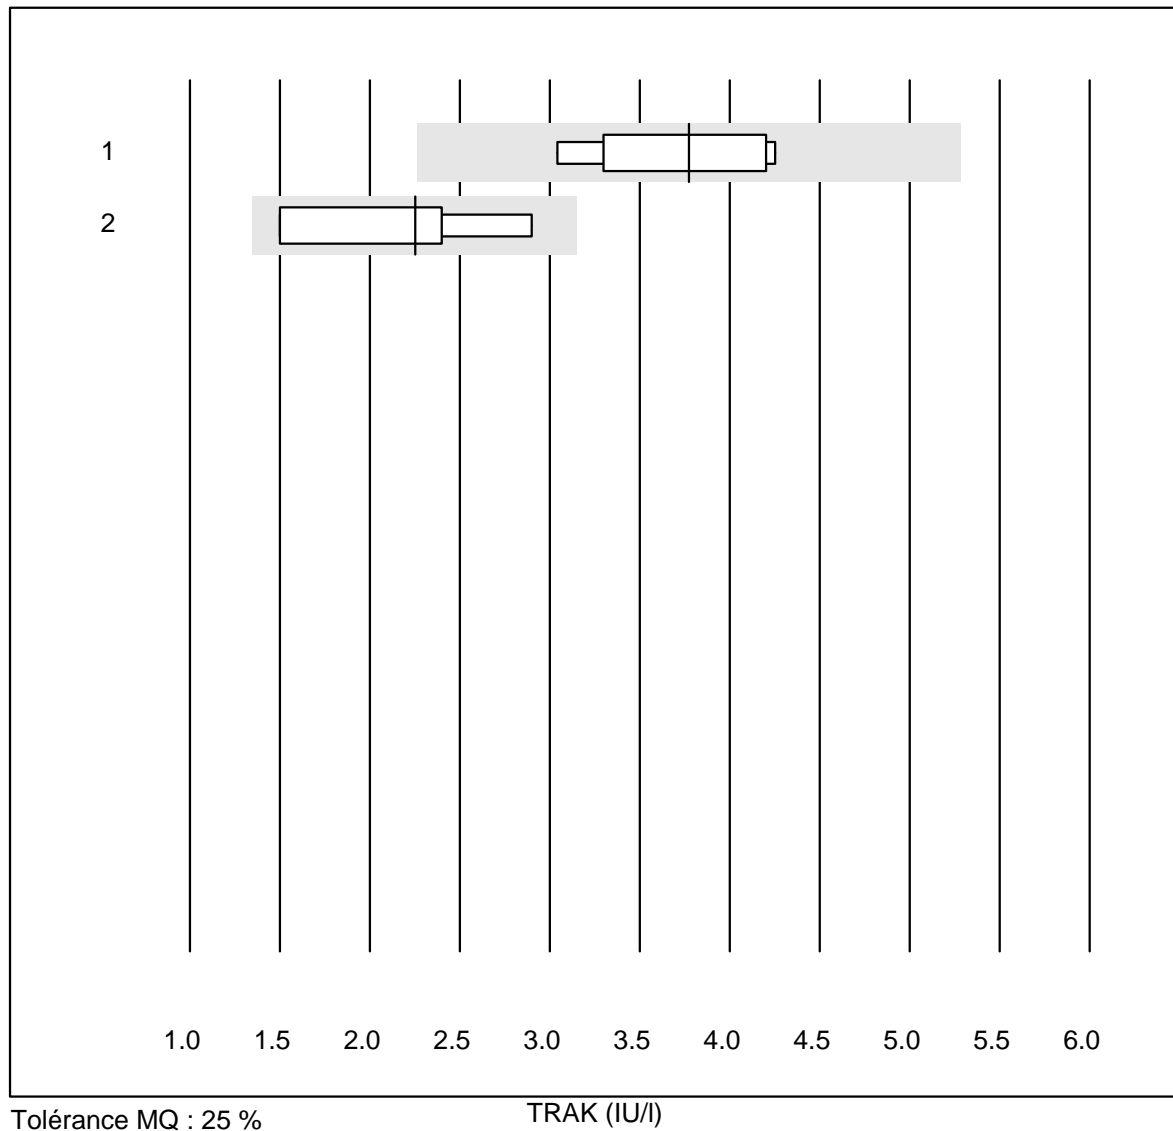

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas	7	100.0	0.0	0.0	3.78	12.6	a
2 Kryptor	4	100.0	0.0	0.0	2.25	25.8	a

Créatinine WB

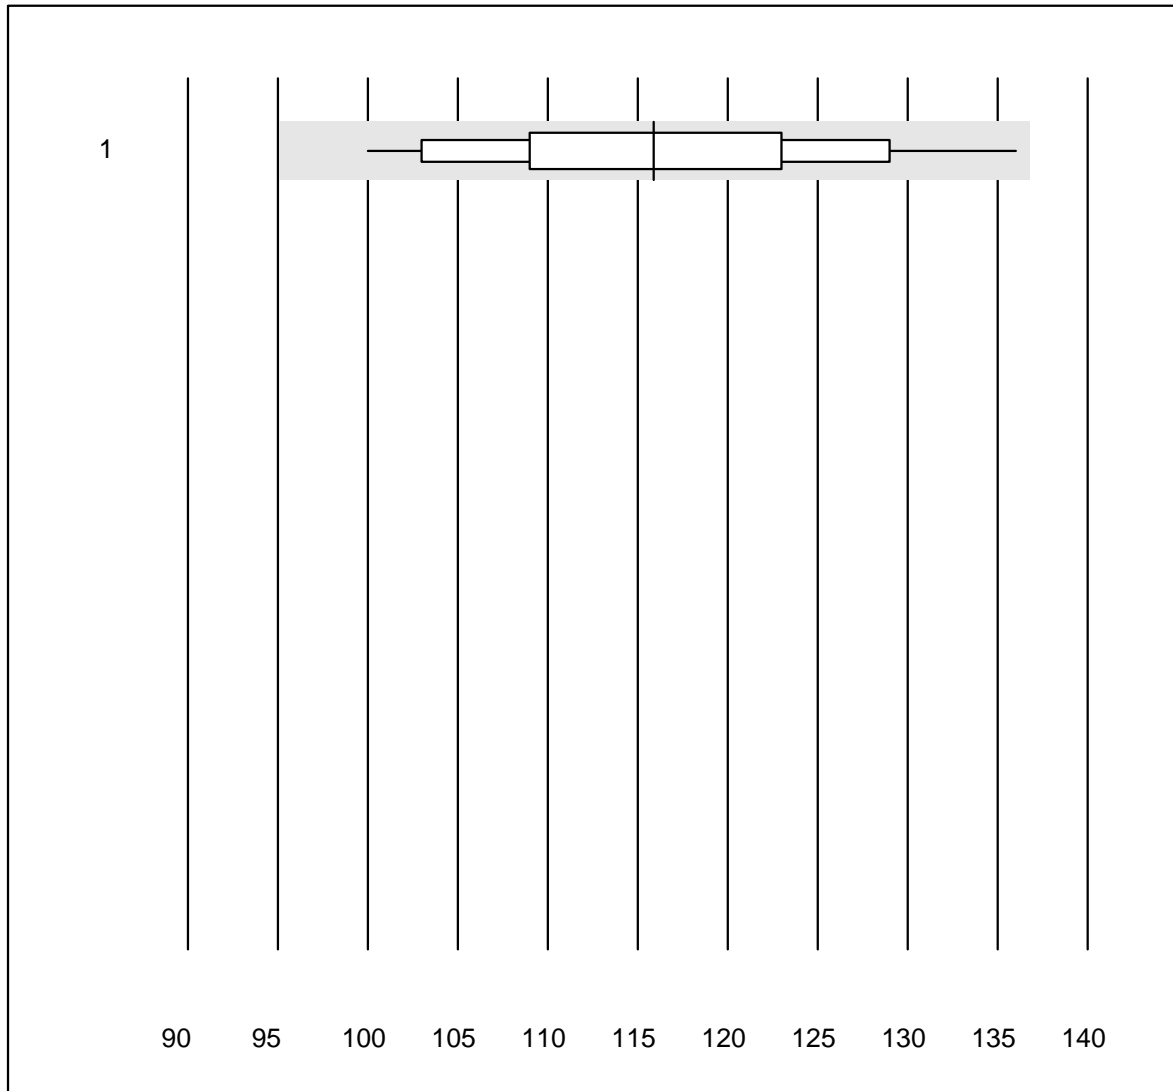


QUALAB Tolérance : 18 %

Créatinine WB (µmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Statsensor i / Nova	52	94.2	0.0	5.8	116	8.0	e

IL6

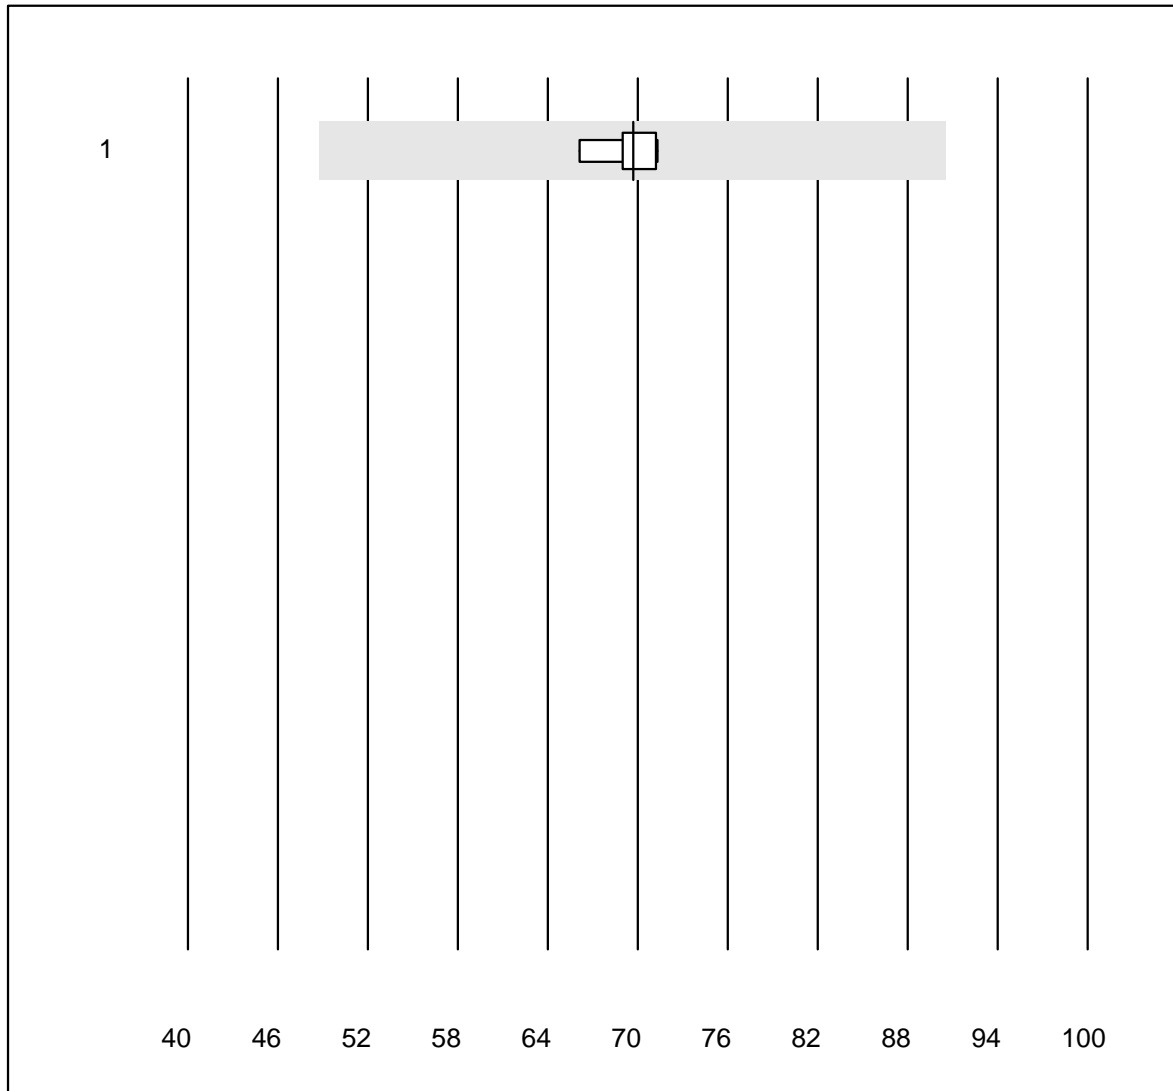


Tolérance MQ : 30 %

IL6 (ng/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas	6	100.0	0.0	0.0	69.7	2.7	e

Amylase-urine

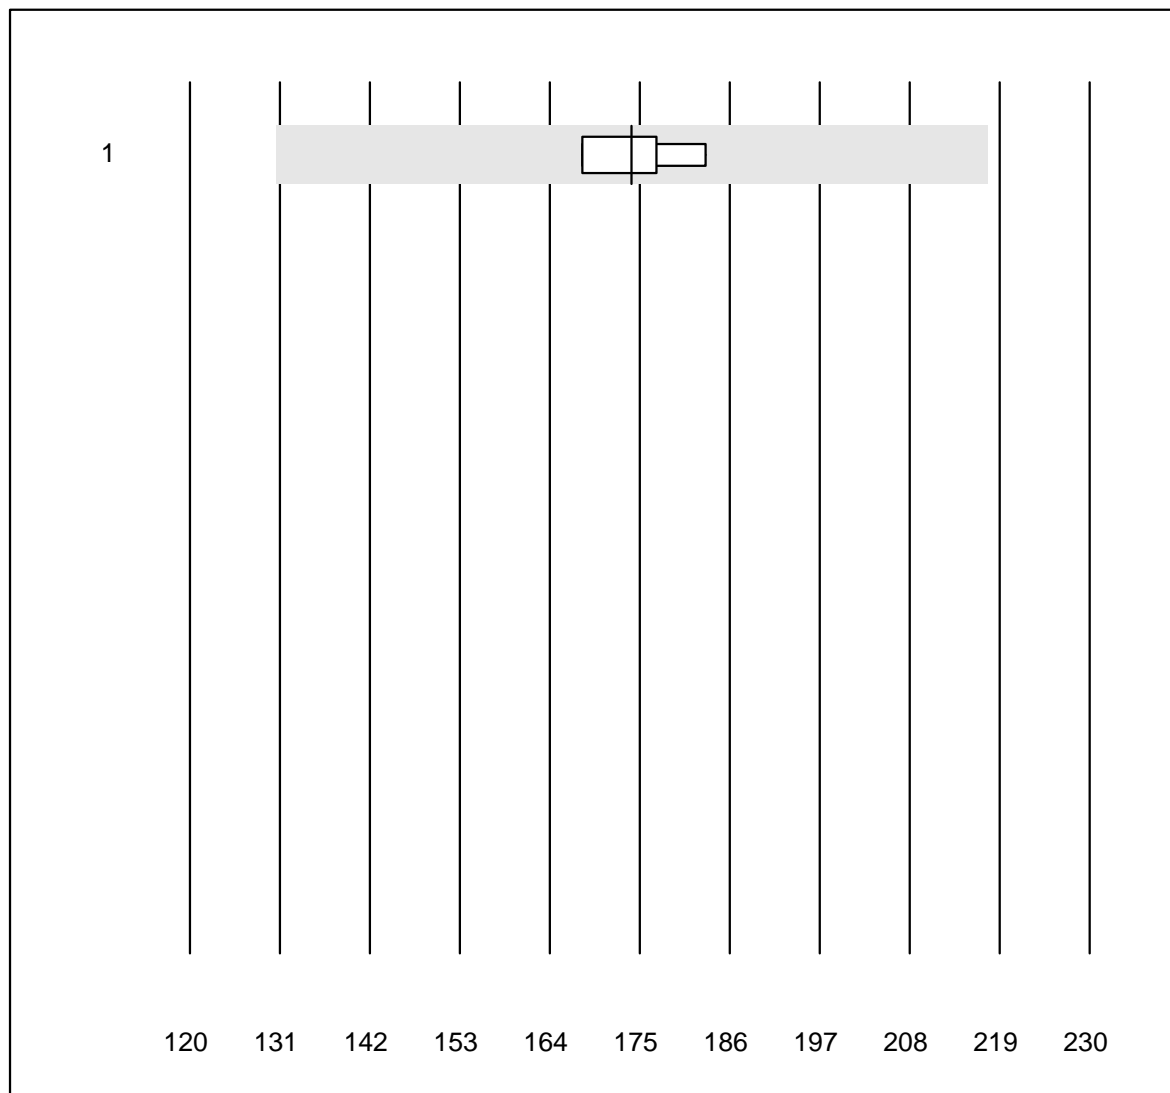


Tolérance MQ : 25 %

Amylase-urine (U/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 IFCC	4	100.0	0.0	0.0	174	3.8	e

Calcium-urine

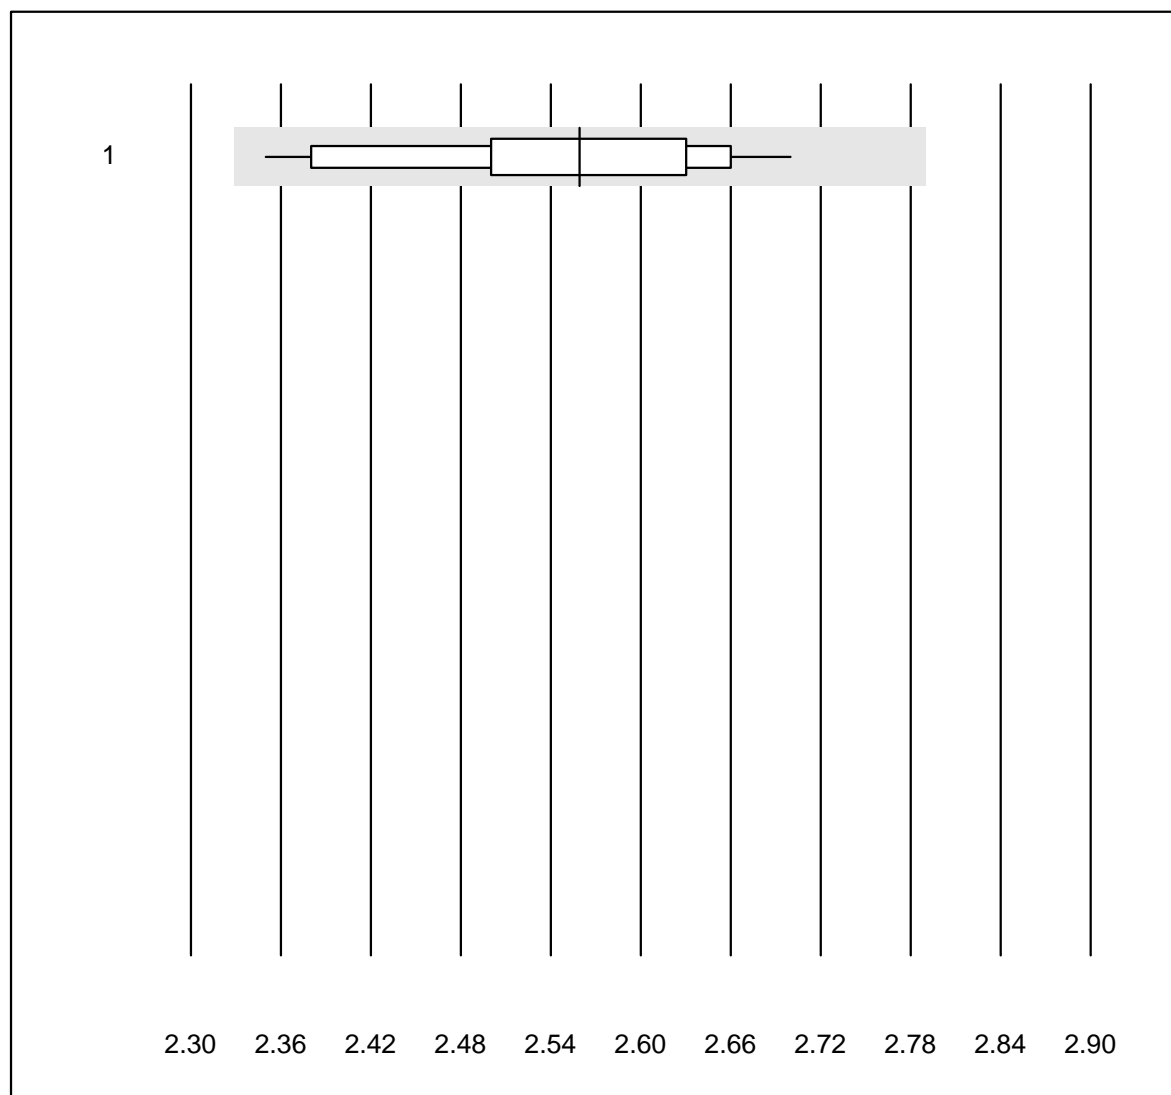


Tolérance MQ : 9 %

Calcium-urine (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Chimie humide	20	100.0	0.0	0.0	2.56	4.0	e

Chlorures-urine

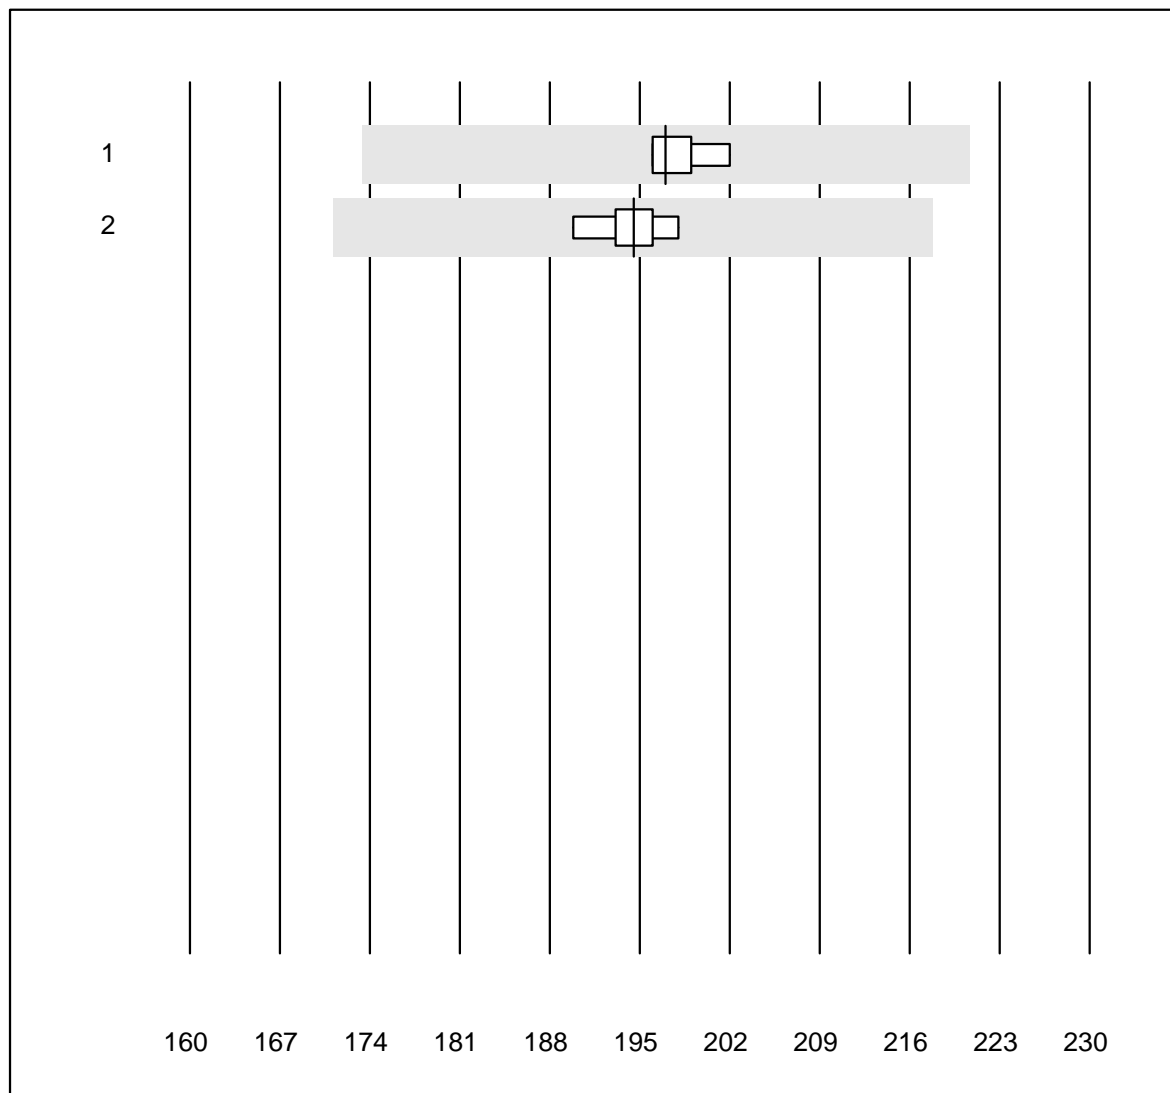


Tolérance MQ : 12 %

Chlorures-urine (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Chimie humide	6	100.0	0.0	0.0	197	1.2	e
2 Cobas	6	100.0	0.0	0.0	195	1.4	e

Glucose-urine

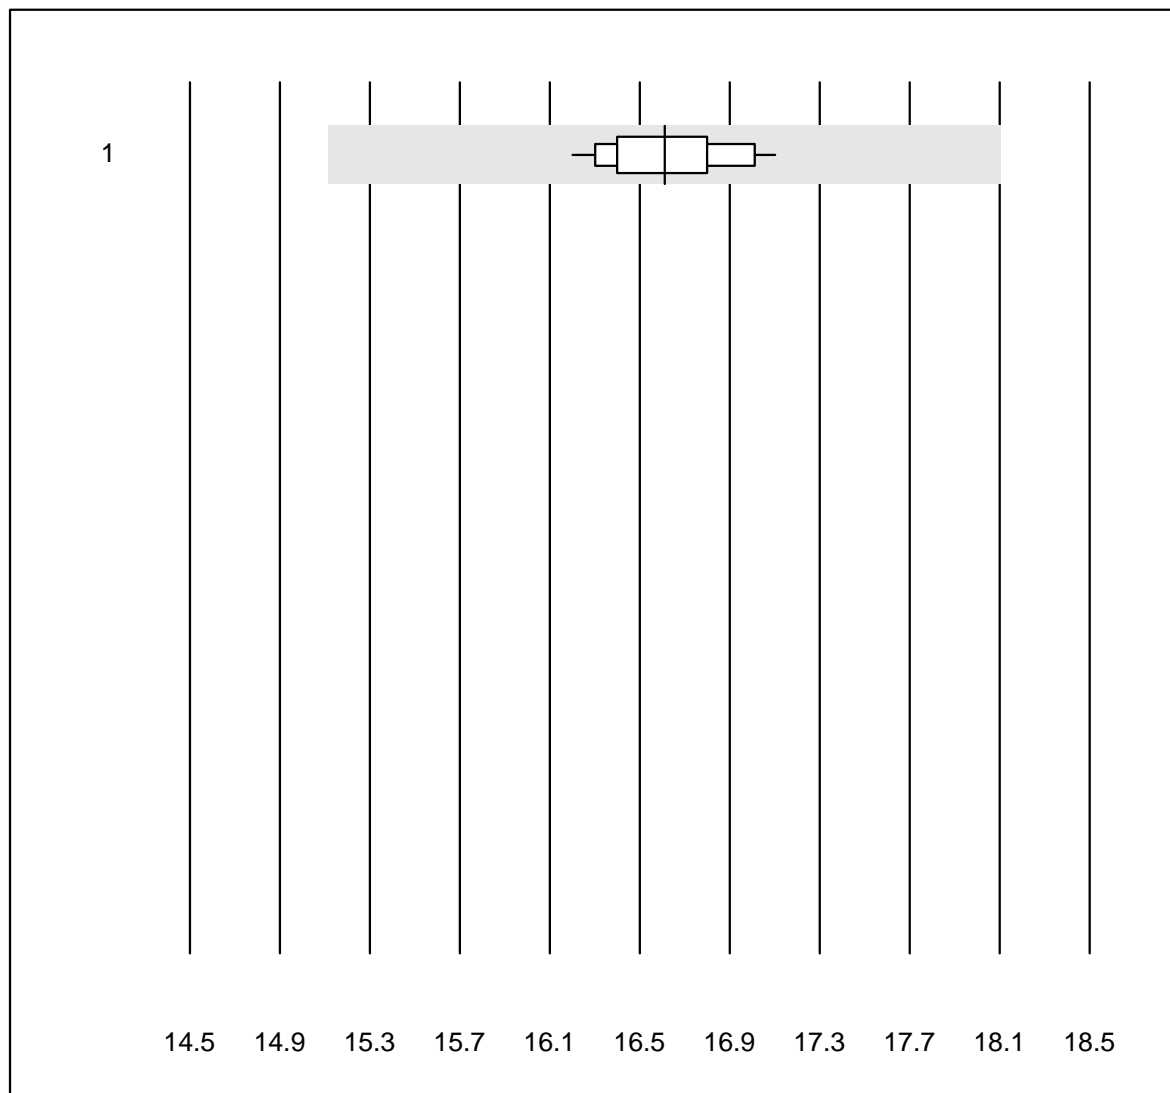


QUALAB Tolérance : 9 %

Glucose-urine (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Chimie humide	17	100.0	0.0	0.0	16.6	1.7	e

Magnésium-urine

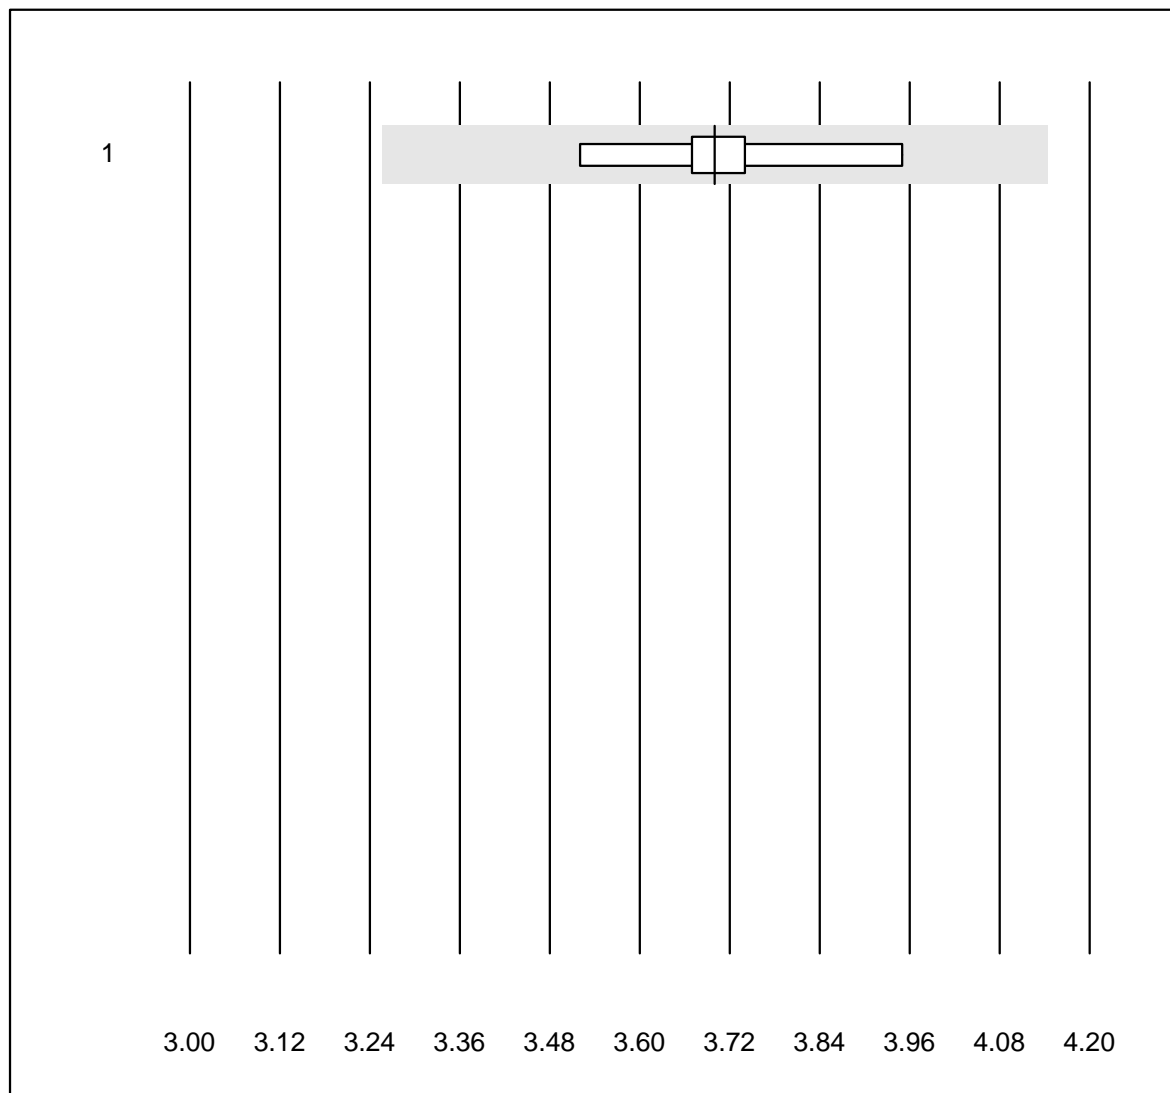


Tolérance MQ : 12 %

Magnésium-urine (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Chimie humide	9	100.0	0.0	0.0	3.70	3.6	e

Osmolalité-urine

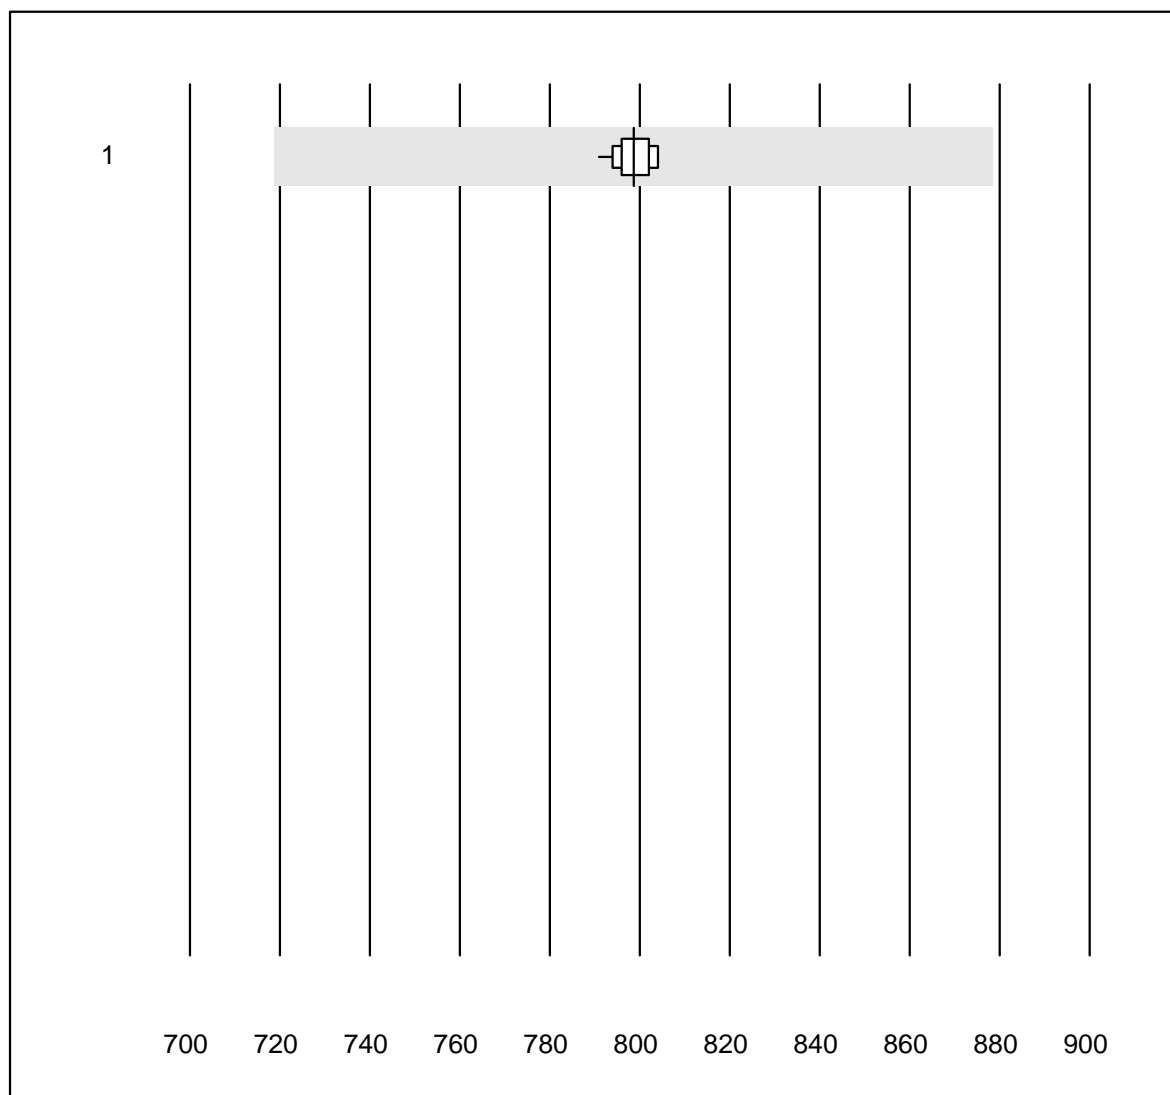


Tolérance MQ : 10 %

Osmolalité-urine (mosm/kg)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cryoscopie	15	100.0	0.0	0.0	799	0.5	e

Phosphore-urine

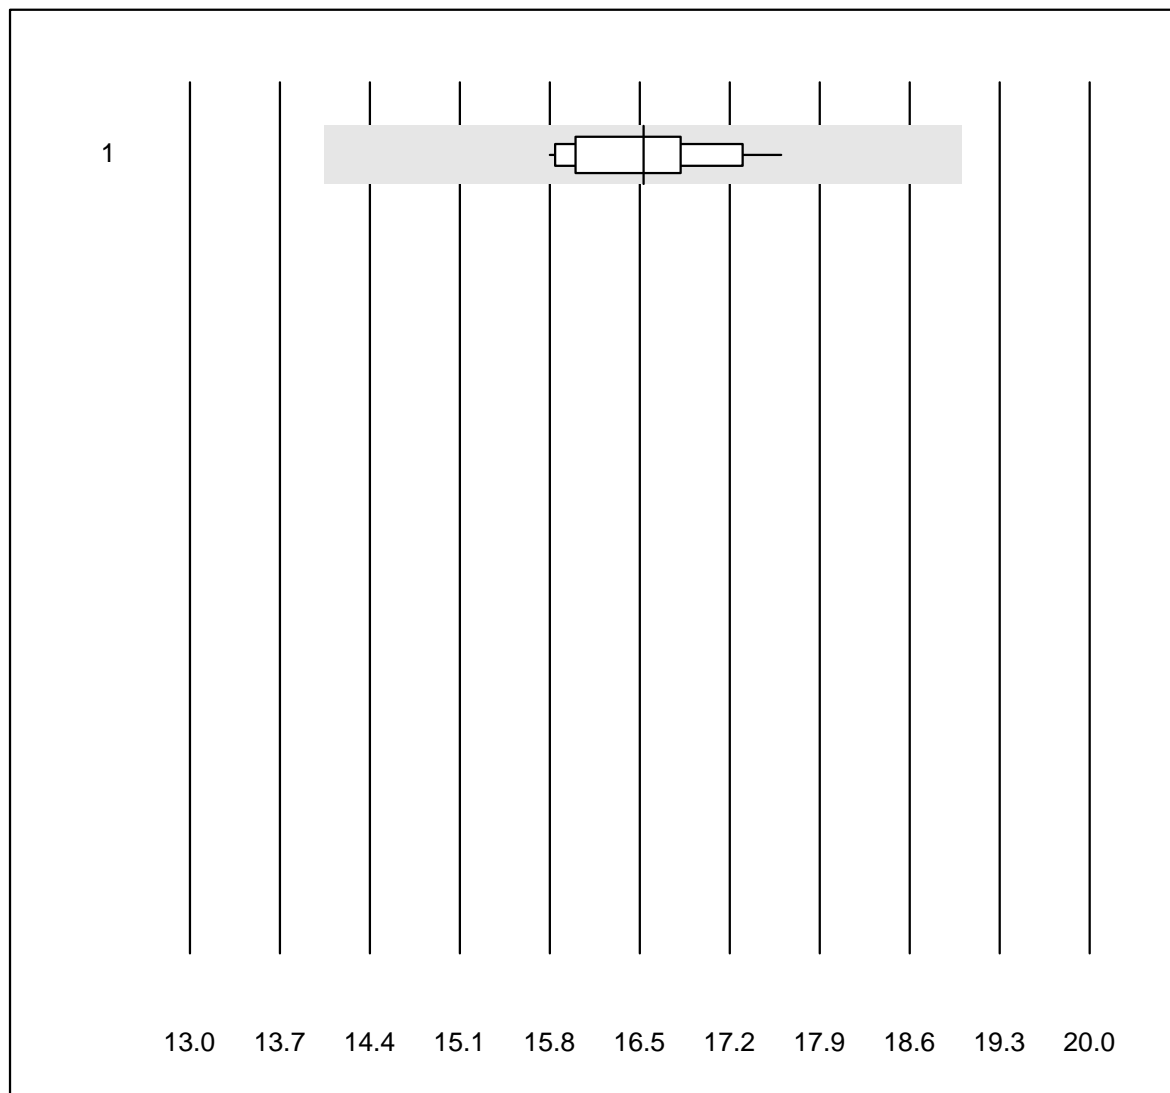


Tolérance MQ : 15 %

Phosphore-urine (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Chimie humide	16	100.0	0.0	0.0	16.5	3.2	e

Potassium-urine

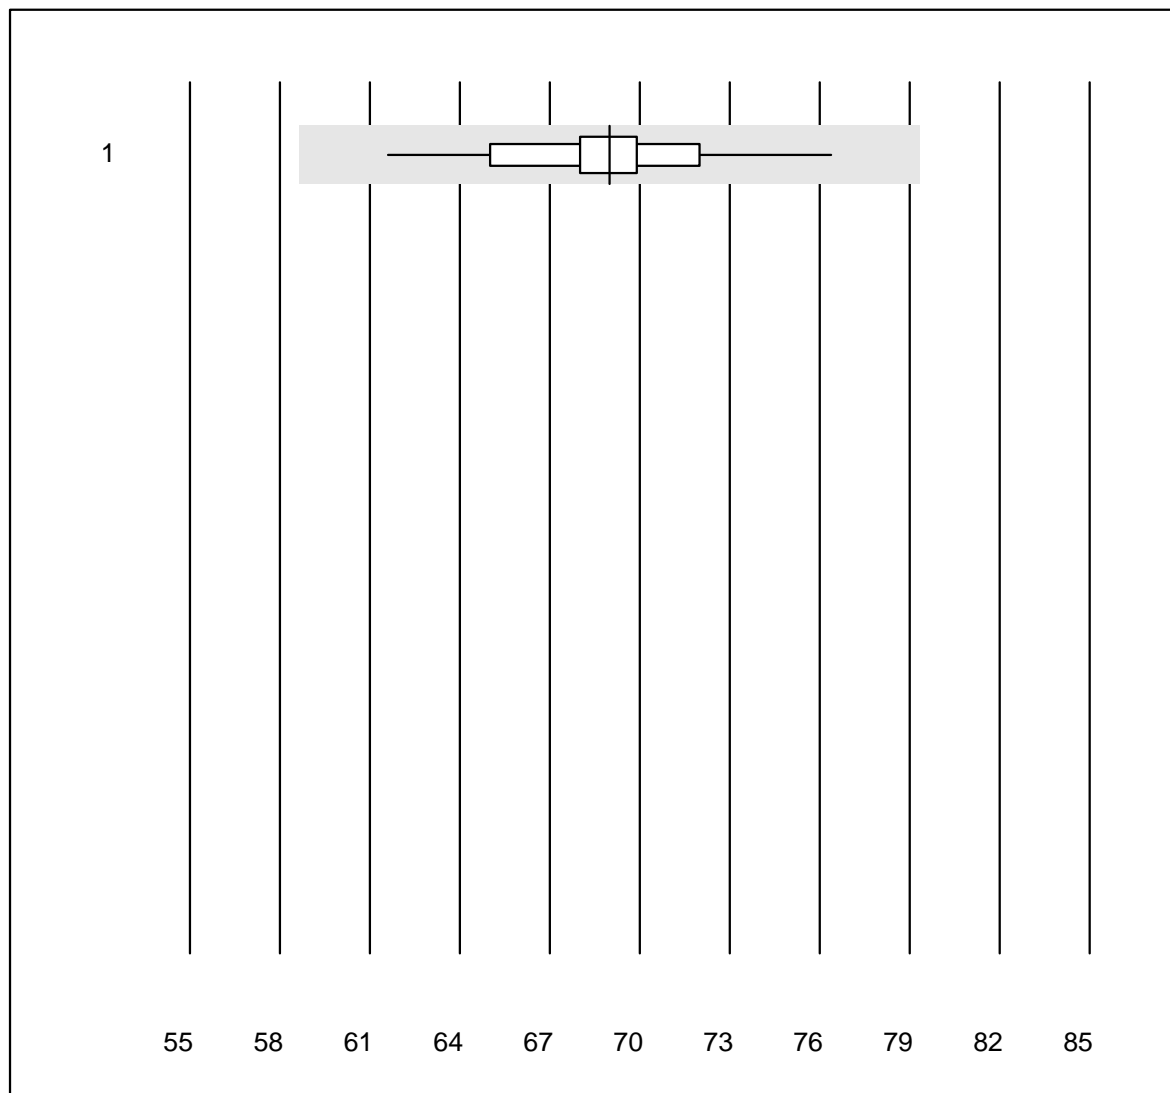


Tolérance MQ : 15 %

Potassium-urine (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	26	100.0	0.0	0.0	69	4.3	e

Protéines-urine

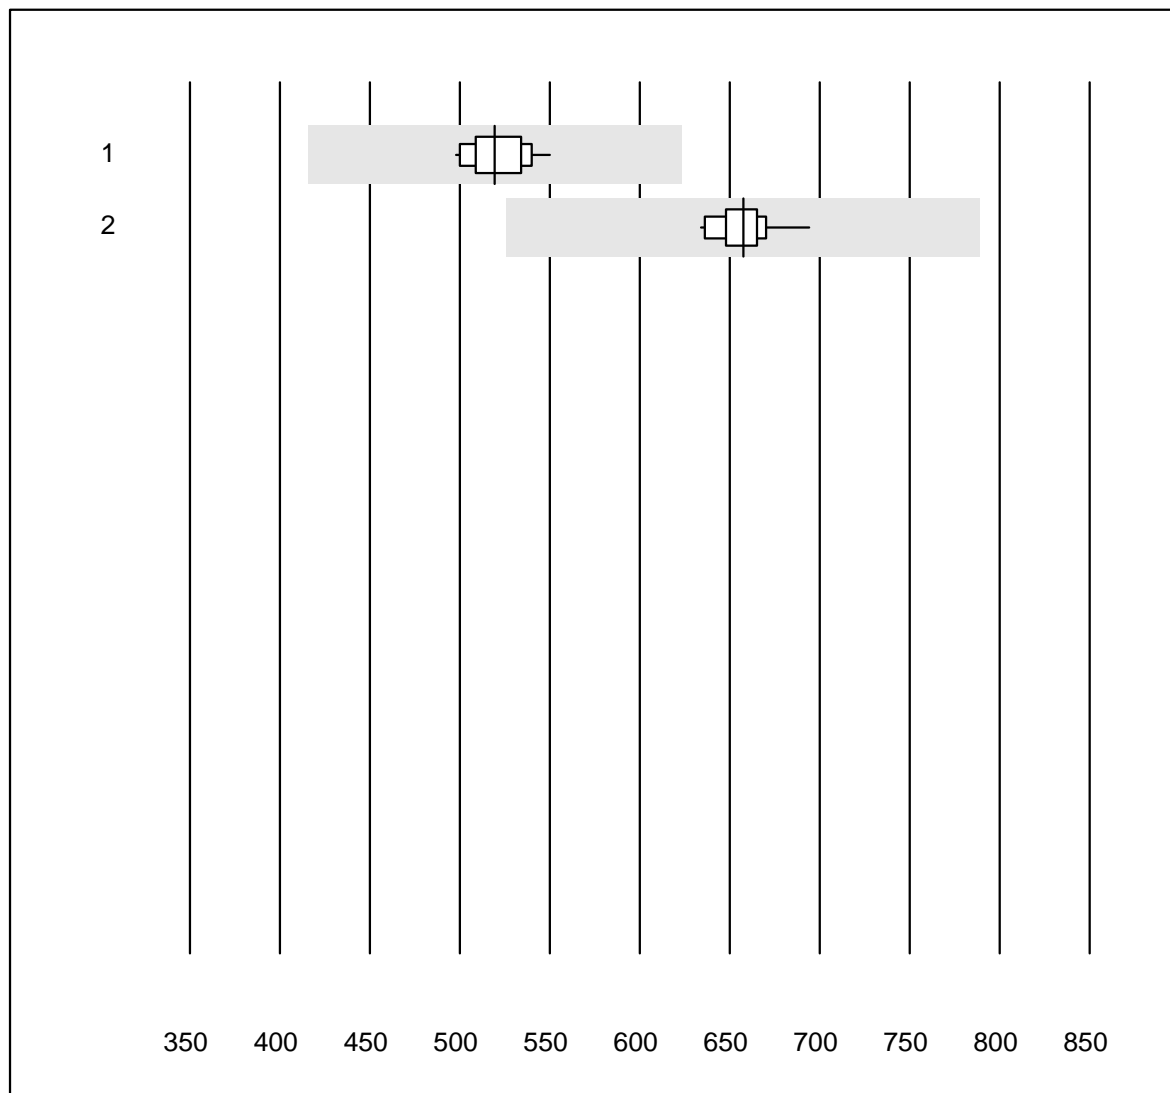


QUALAB Tolérance : 20 %

Protéines-urine (mg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Cobas/Roche	15	100.0	0.0	0.0	519.3	3.2	e
2 Chimie humide	11	100.0	0.0	0.0	657.5	2.5	e

Sodium-urine

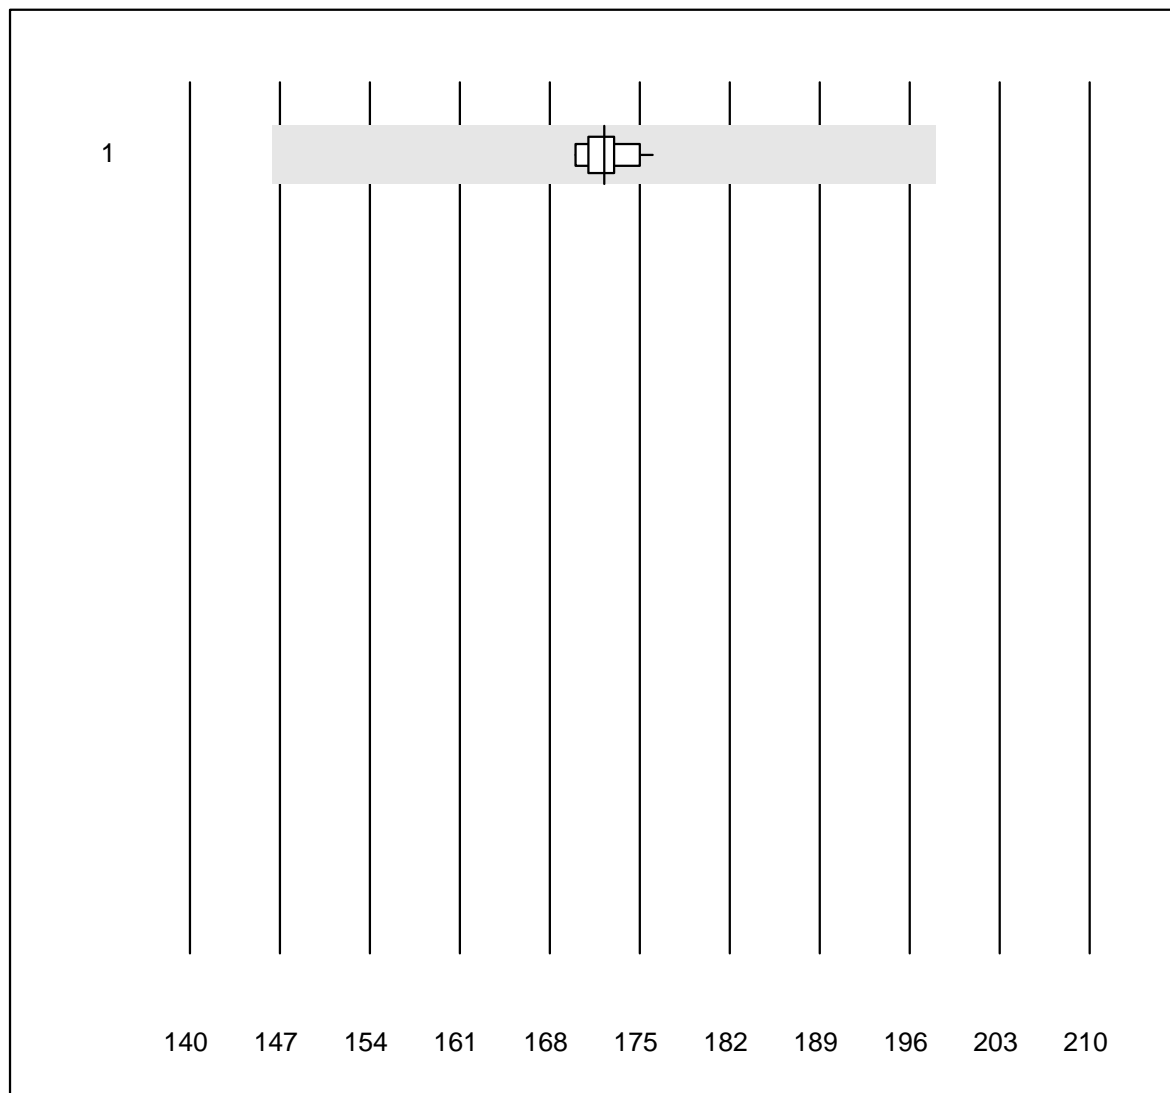


Tolérance MQ : 15 %

Sodium-urine (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 toutes les méthodes	26	100.0	0.0	0.0	172	1.0	e

Urée-urine

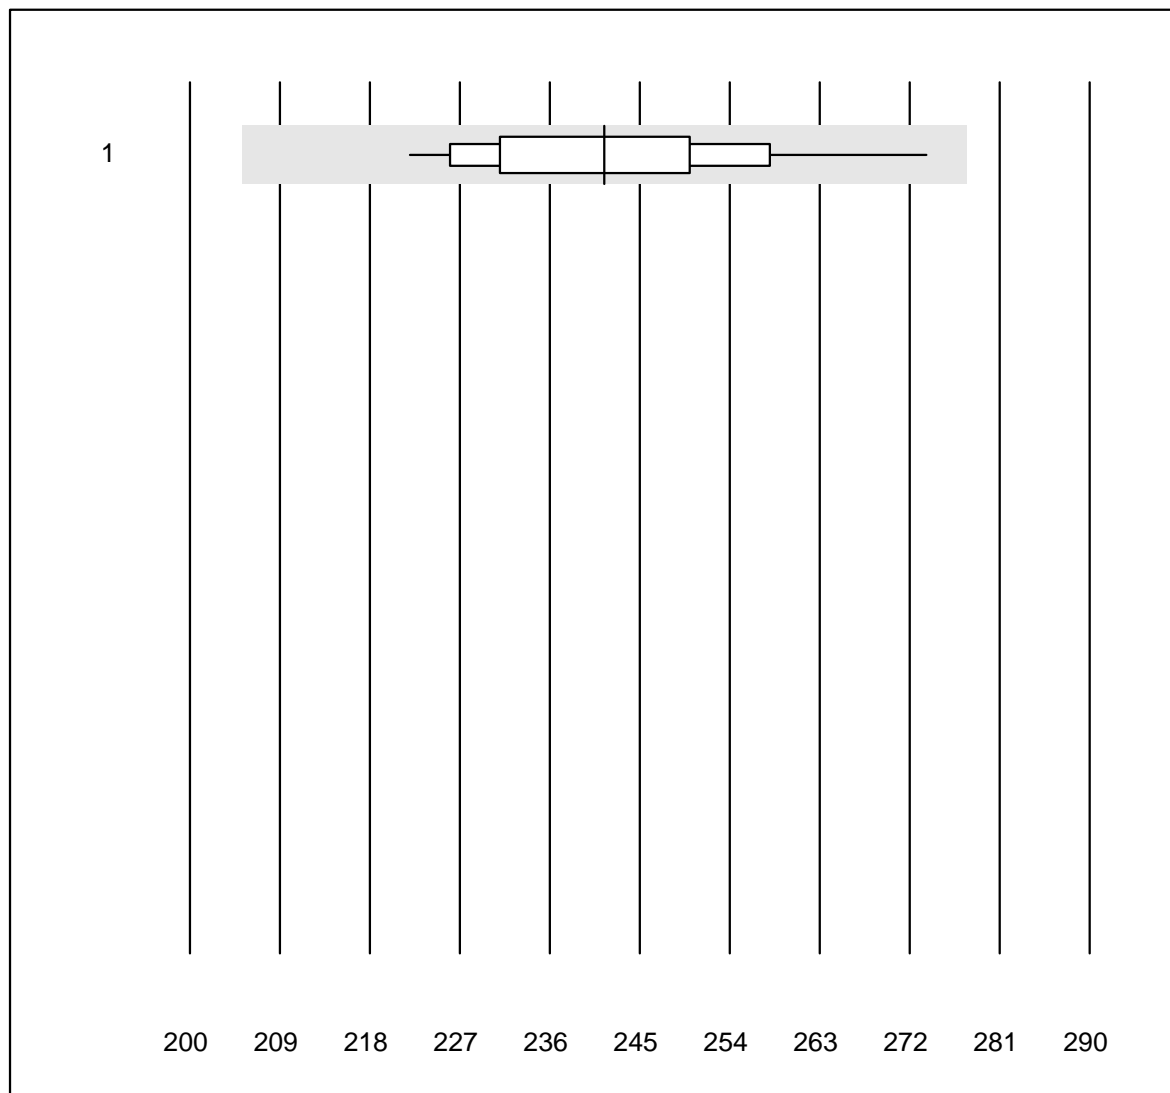


Tolérance MQ : 15 %

Urée-urine (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Chimie humide	22	100.0	0.0	0.0	241	5.8	e

Acide urique-urine

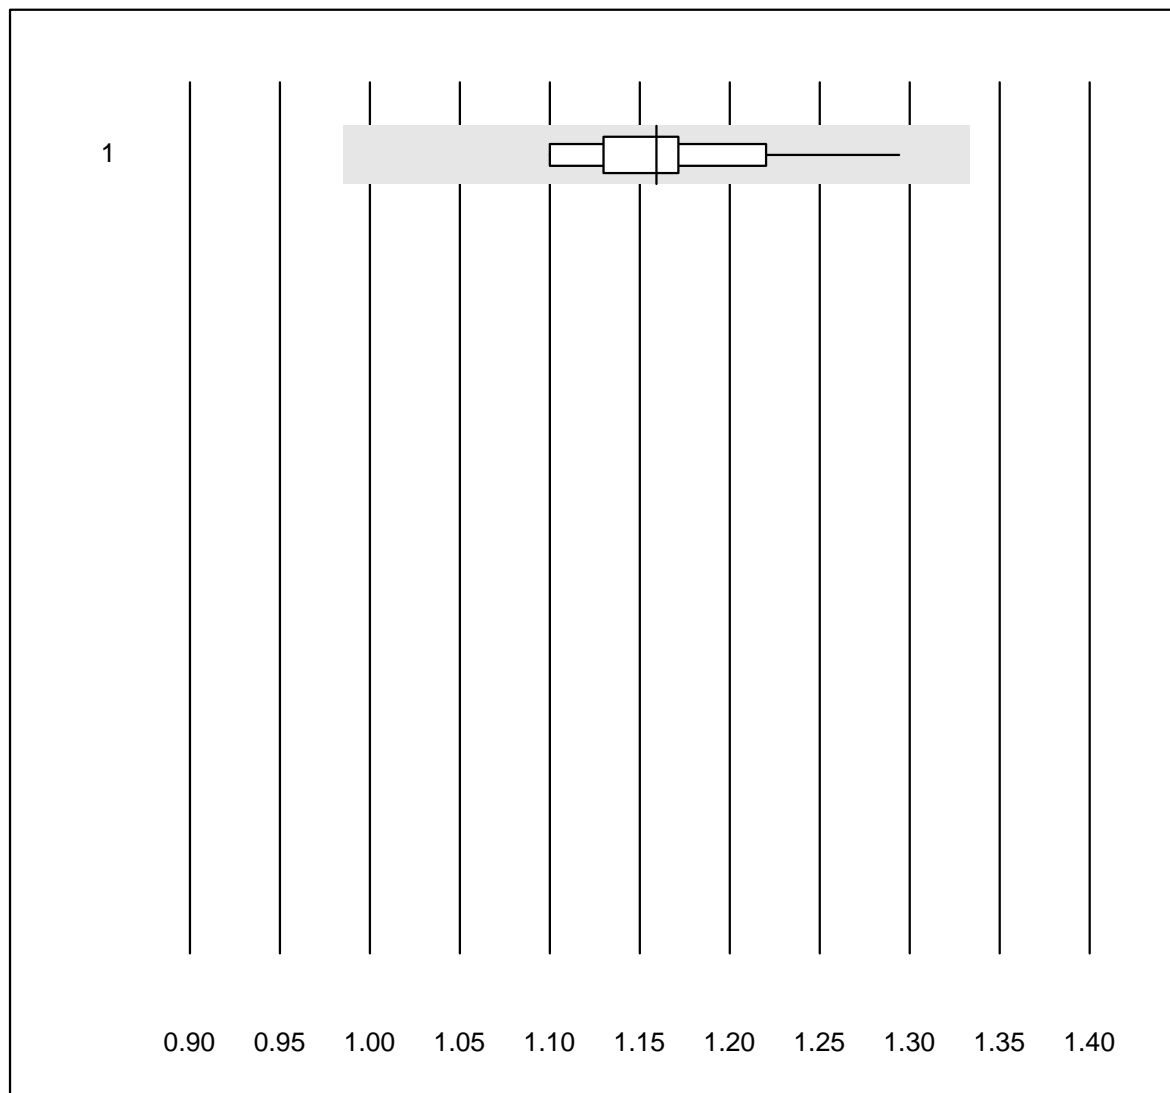


Tolérance MQ : 15 %

Acide urique-urine (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Chimie humide	16	100.0	0.0	0.0	1.16	4.0	e

Gravité spécifique-urine

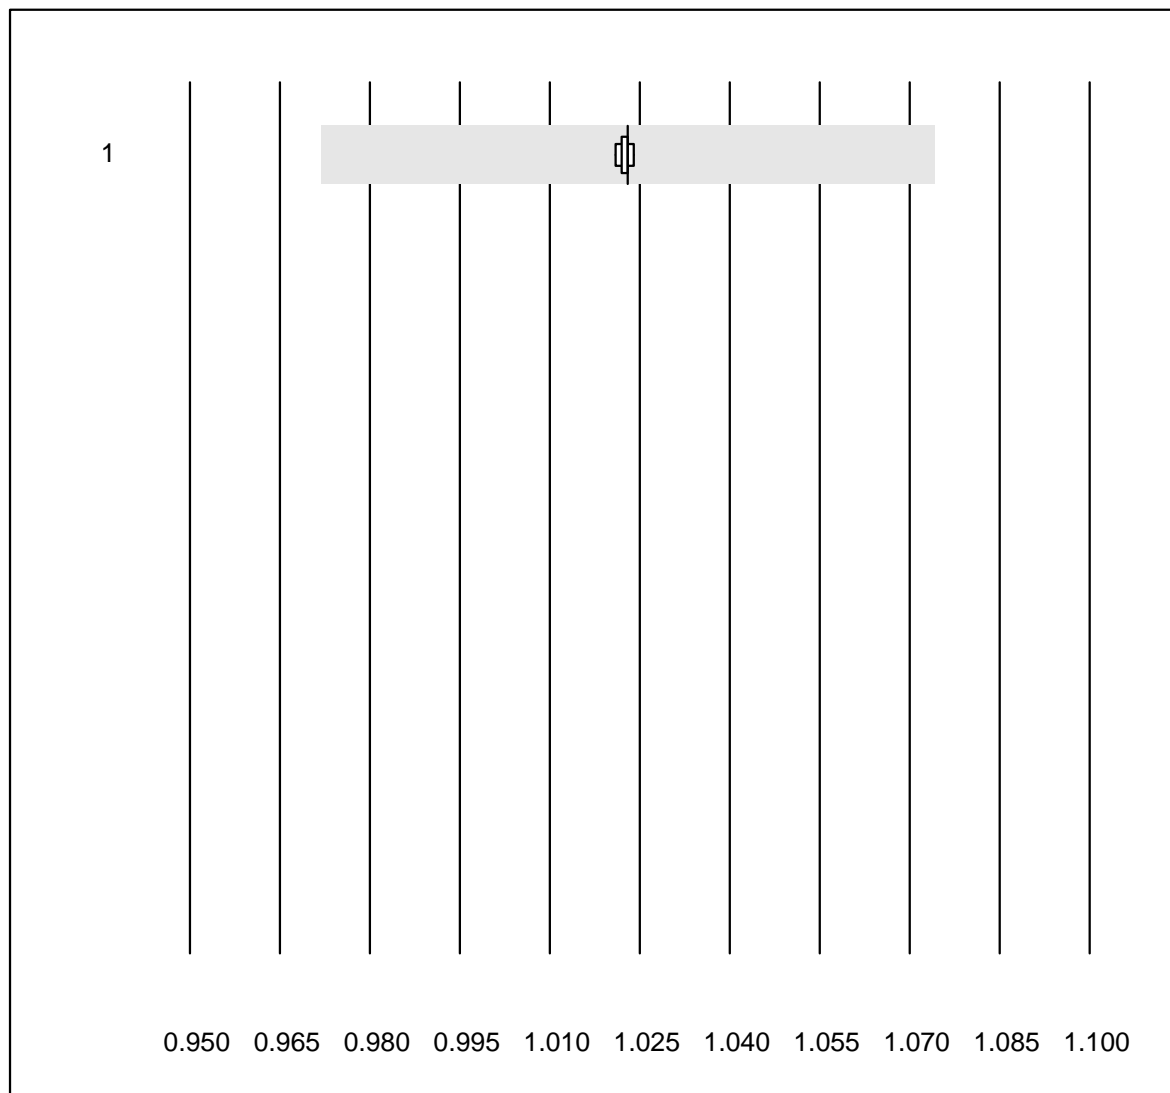


Tolérance MQ : 5 %

Gravité spécifique-urine ()

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Refraktometer	5	100.0	0.0	0.0	1.023	0.1	e

Microalbumine

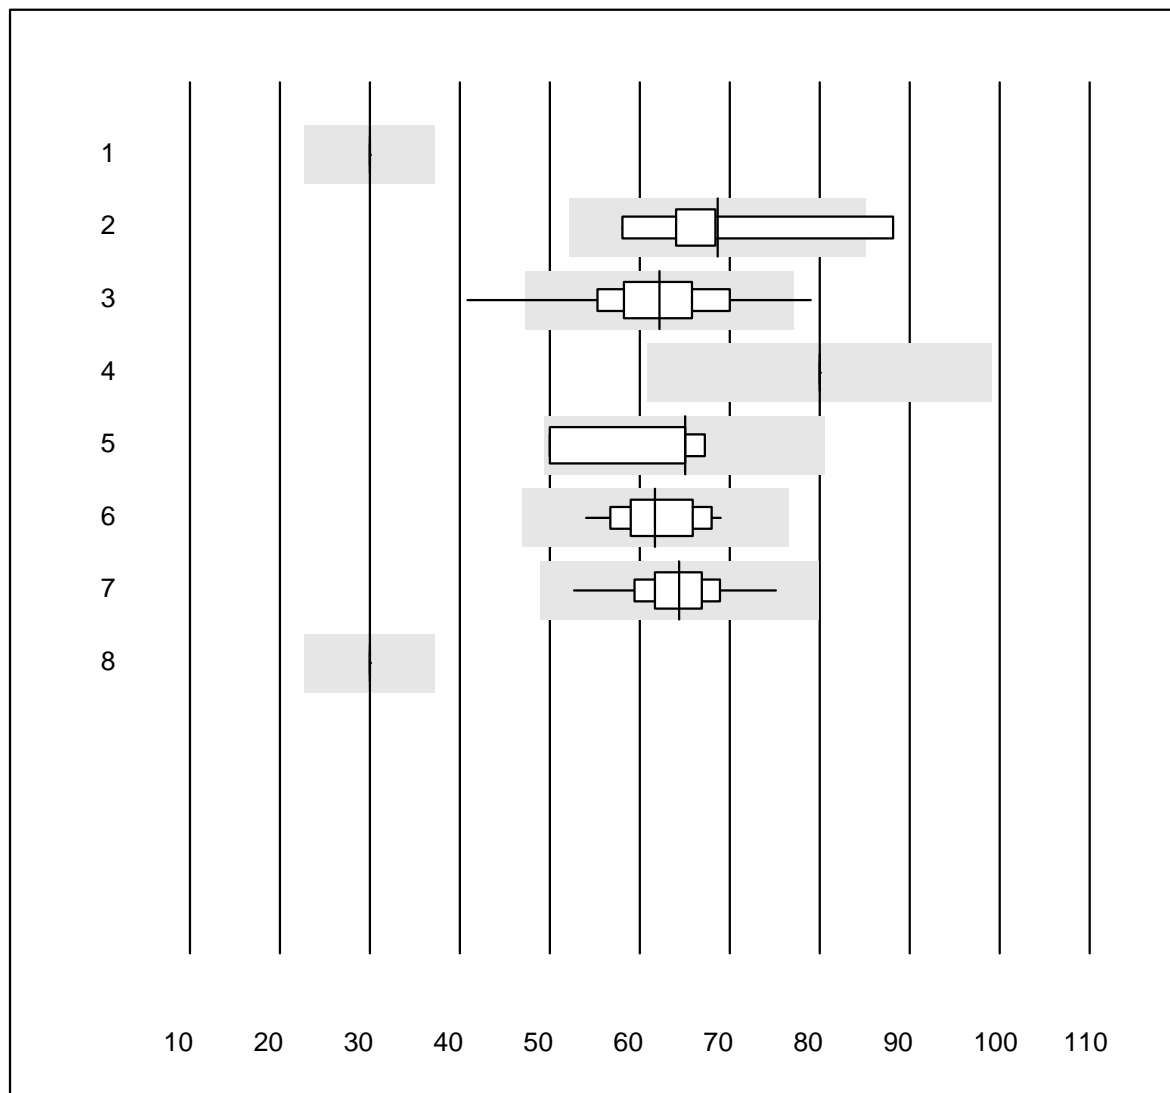


QUALAB Tolérance : 24 %

Microalbumine (mg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1 Aution	4	50.0	0.0	50.0	30.0	0.0	e
2 AFIAS	10	80.0	10.0	10.0	68.7	12.5	e*
3 Afinion	454	96.7	2.0	1.3	62.2	9.6	e
4 Sysmex U	19	73.7	0.0	26.3	80.0	0.0	e
5 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	65.0	12.8	e*
6 Turbidimetrie	26	100.0	0.0	0.0	61.7	6.7	e
7 DCA2000/Vantage	146	93.2	0.0	6.8	64.4	6.2	e
8 Siemens Clinitek	13	76.9	0.0	23.1	30.0	0.0	e

Créatinine urine

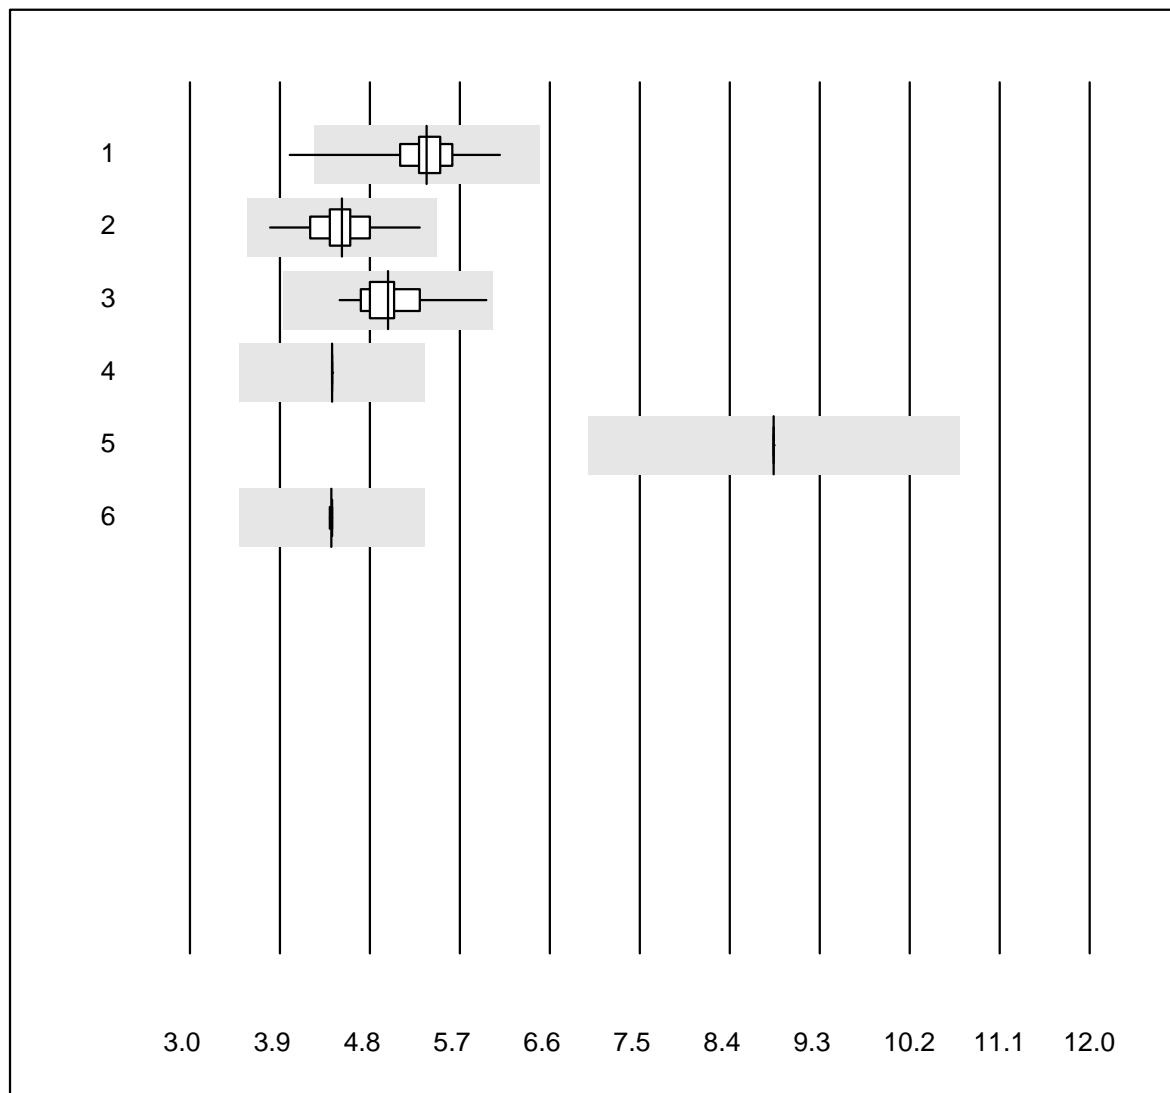

QUALAB Tolérance : 21 %

Créatinine urine (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% Abberant	Valeur cible	VK%	Type
1	DCA2000/Vantage	146	92.5	0.7	6.8	5.4	5.2	e
2	Afinion	455	98.2	0.0	1.8	4.5	4.8	e
3	Chimie humide	40	97.5	0.0	2.5	5.0	5.6	e
4	Sysmex U	15	73.3	0.0	26.7	4.4	0.0	e
5	Aution	4	75.0	0.0	25.0	8.8	0.0	e
6	Siemens Clinitek	13	69.2	0.0	30.8	4.4	0.2	e