

Verein für
Association pour le
Associazione per il



medizinische Qualitätskontrolle
contrôle de qualité médical
controllo di qualità medico

Commentaire de l'essai interlaboratoire

2021 - 4

Échantillons de l'essai interlaboratoire

L'homogénéité et la stabilité ont été vérifiées pour tous les échantillons avant respectivement pendant l'envoi et aucune anomalie n'a été constatée. Les tests de conformité ont été réalisés par les laboratoires de l'Hôpital Universitaire de Zürich (<http://www.uzl.usz.ch/>).

Ont été produits spécifiquement pour MQ en sous-traitance les échantillons d'essai interlaboratoire suivants:

B1 Strep A Test, B2 Uricult, H4 Hématologie parasitaire, K14 Marqueur tumoral

Détermination des valeurs-cible

Pour chaque valeur-cible est indiqué le mode de détermination utilisé selon les termes de la norme ISO17043:2010, B2.1 (Colonne "Type"):

- a Valeur connue, sur la base de la production.
- b Valeur de référence certifiée lors de l'utilisation d'échantillons spécifiques
- c Valeur de référence déterminée par analyse
- d „Consensus value“ des laboratoires d'experts
- e „Consensus value“ des participants

Pour les groupes de méthode incluant plus de 9 participants, les valeurs cibles sont déterminées comme étant la „Consensus value“ ("e") des participants. Pour la détermination de ces valeurs cibles est utilisée la moyenne réalisée par le groupe de méthodes. Les résultats qui présentent un écart par rapport à la valeur cible supérieur à 1.5 fois la tolérance Qualab, sont considérés comme résultats aberrants et exclus du calcul de la valeur de référence. Les résultats des essais d'aptitude sont utilisés comme valeur de base pour éliminer les taux aberrants. Afin de mettre à disposition de tous les participants des valeurs-cible les plus pertinentes possibles, d'autres procédures peuvent également être utilisées pour des groupes de méthode plus restreints.

Incertitude dans la détermination des valeurs-cible

L'incertitude-type (u_x) est calculée à l'aide de la formule suivante (ISO13528):

$$u_x = (\text{Valeur-cible}/100) * (1.25/\text{Racine carrée du "nombre des participants"}) * \text{CV en \%}$$

- u_x est exprimée dans la même unité que la valeur-cible
- u_x peut être comparée avec l'écart-type du collectif des participants ($\text{Ecart-type} = \text{Valeur-cible} * \text{CV en \%} / 100$)
- Pour un nombre de participants >18 , l'incertitude-type (u_x) est significativement plus petite que la dispersion du collectif des participants et peut donc être négligée.


Tolérances QUALAB et MQ

Pour les analyses obligatoires sont utilisées les tolérances fixées par Qualab (www.qualab.ch, contrôle de qualité externe). Pour les analyses non-obligatoires, les tolérances sont fixées par le directeur de MQ pilotant l'essai interlaboratoire.

Si l'incertitude déterminée de la valeur de référence u_x est supérieure à 15% de la tolérance QUALAB ou de MQ, la lettre qui caractérise le type de détermination de la valeur-cible est en outre marquée d'une étoile (par exemple "e*"). Nous rendons ainsi les participants attentifs au fait que l'incertitude de la valeur de référence peut avoir une influence sur l'évaluation.

Représentation graphique

La représentation graphique des résultats est la suivante:

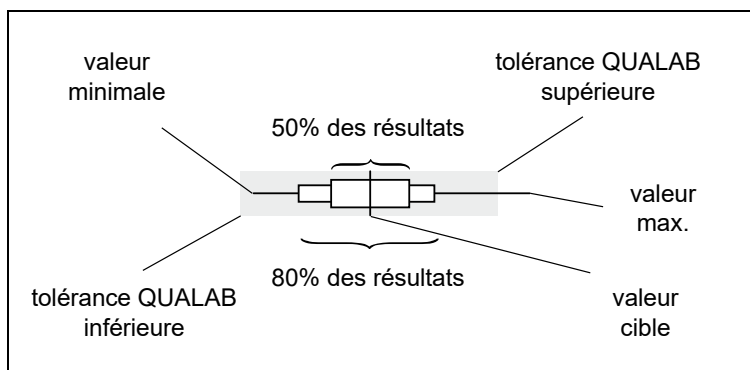


Comparaison des appareils

Les données de ce rapport vous permettent de comparer les performances respectives des divers appareils. Toutefois, vous devez tenir compte des points suivants:

- Le contrôle Chimie K1 est un sérum de contrôle commercialisé prêt à l'emploi. Même si l'échantillon est d'origine humaine, des effets matriciels sont possibles. Ceux-ci dépendent de l'appareil et peuvent générer des valeurs cible différentes.
- Seul un échantillon a été mesuré. La dispersion des résultats étant dépendante de la nature de l'échantillon (effets matriciels) et du niveau du résultat, les coefficients de variation déterminés (CV en %) ne sont pas toujours valables.
- Une grande partie des taux aberrants est due à des erreurs administratives (erreur d'unité, confusion des résultats) ou à des erreurs de manipulation (erreur d'échantillon, dissolution incorrecte, mélange insuffisant) et n'a rien à voir avec le type d'appareil.


Zürich, 14.12.2021



Dr. R. Fried
Directeur de l'essai interlaboratoire

Il n'est pas autorisé de publier une partie ou l'intégralité de ce rapport sans notre accord écrit préalable. L'original est conservé dans les archives sous www.mqzh.ch.

Quick OA

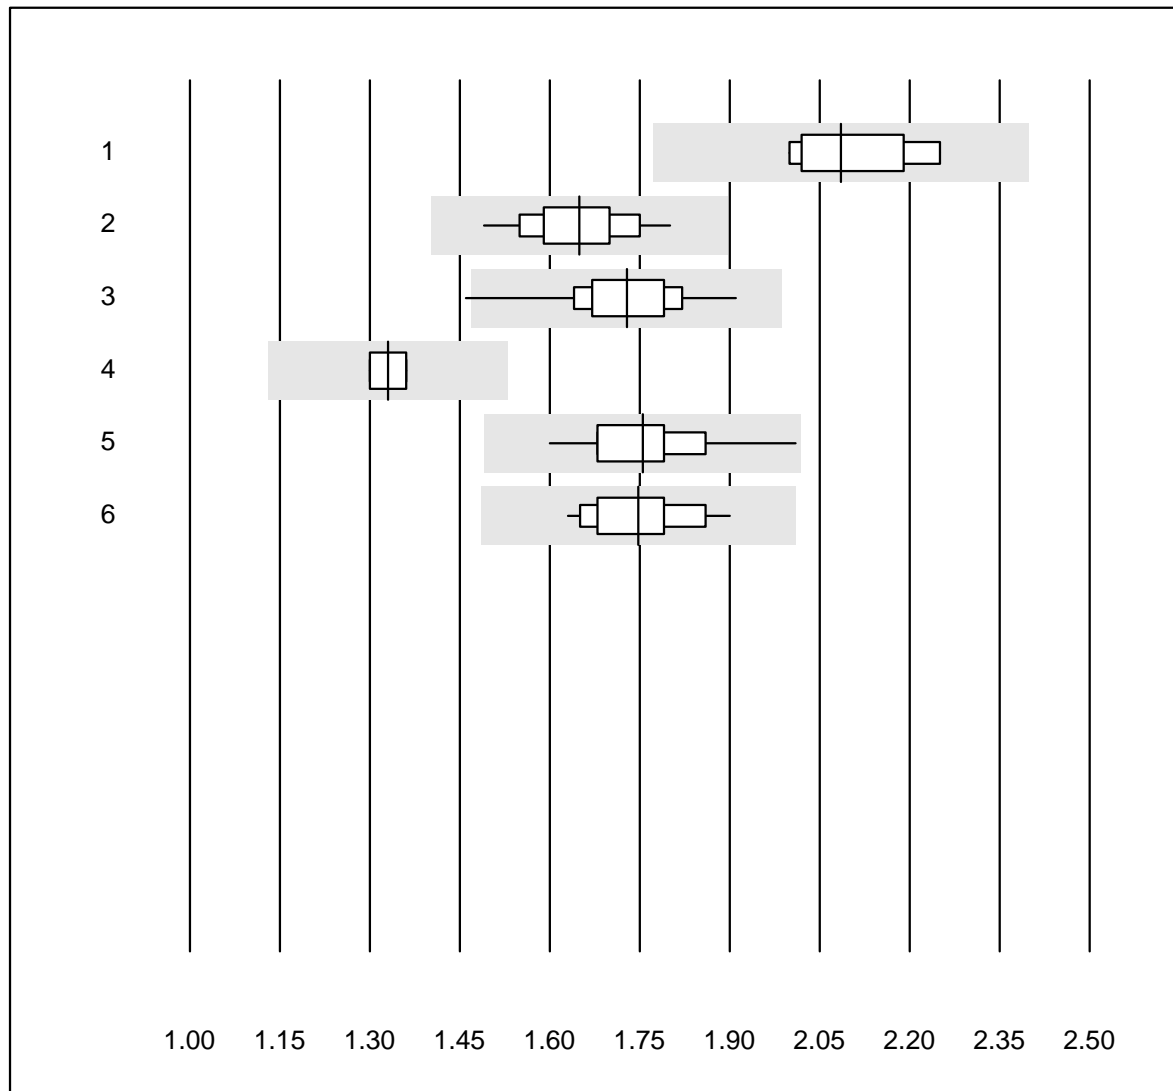


QUALAB Tolérance : 15 %

Quick OA ()


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Neoplastin Plus	6	100.0	0.0	0.0	2.09	4.8	e*
2 Innovin	15	100.0	0.0	0.0	1.65	4.9	e
3 Recombiplastin 2G	11	90.9	9.1	0.0	1.73	6.6	e*
4 Eurolyser	4	50.0	0.0	50.0	1.33	3.2	e
5 Autres méthodes	12	100.0	0.0	0.0	1.76	6.0	e
6 Neoplastin R	12	100.0	0.0	0.0	1.75	4.8	e

Fibrinogène OA

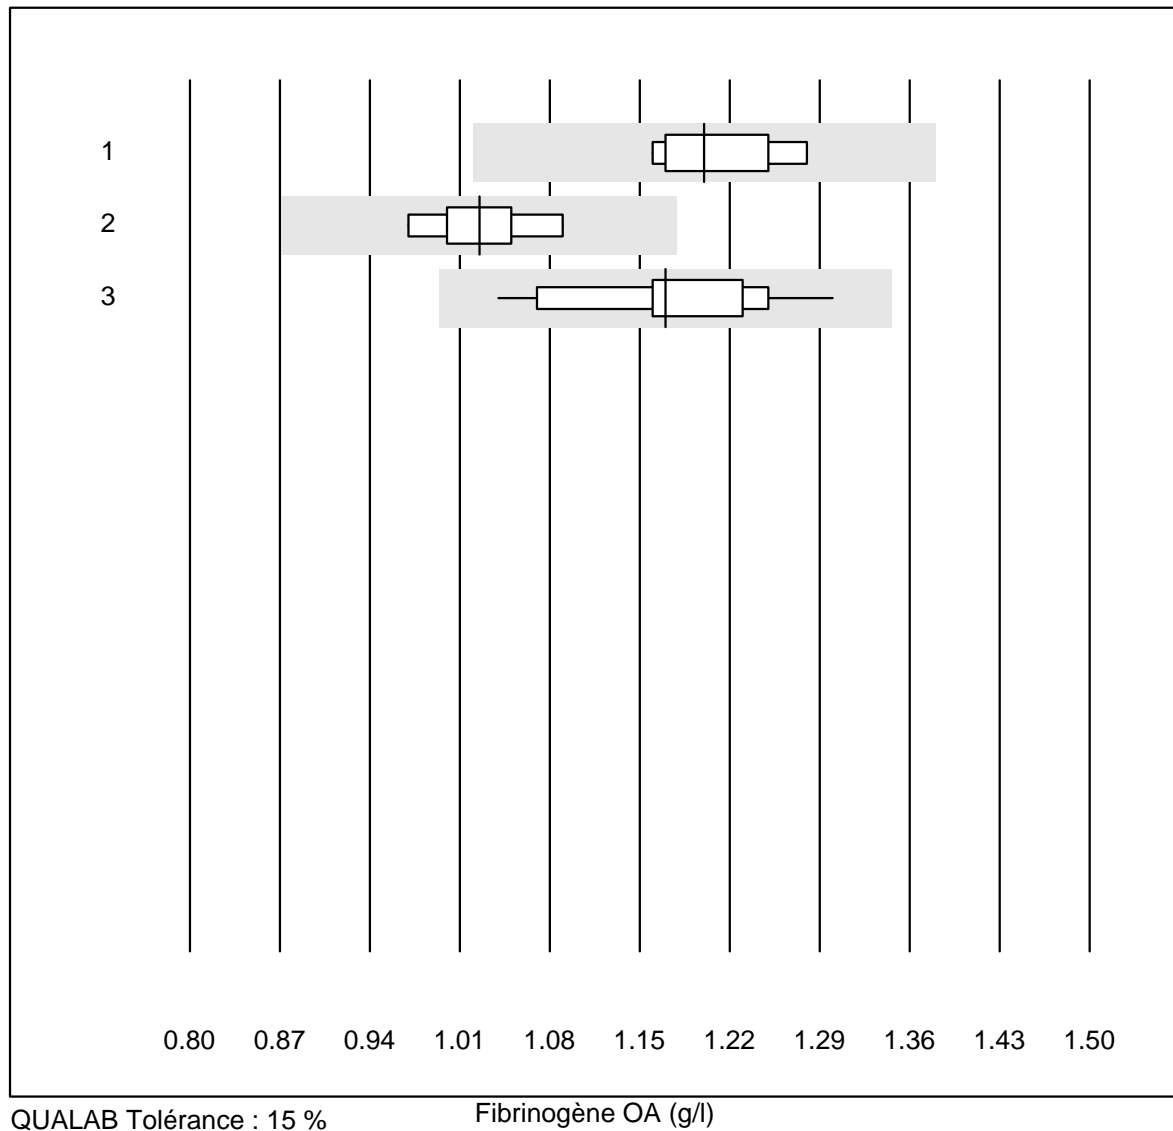

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Autres méthodes	7	100.0	0.0	0.0	1.20	3.6	e
2 Siemens Thrombin	6	100.0	0.0	0.0	1.03	4.0	e
3 Stago/STA	16	100.0	0.0	0.0	1.17	5.6	a

aPTT OA

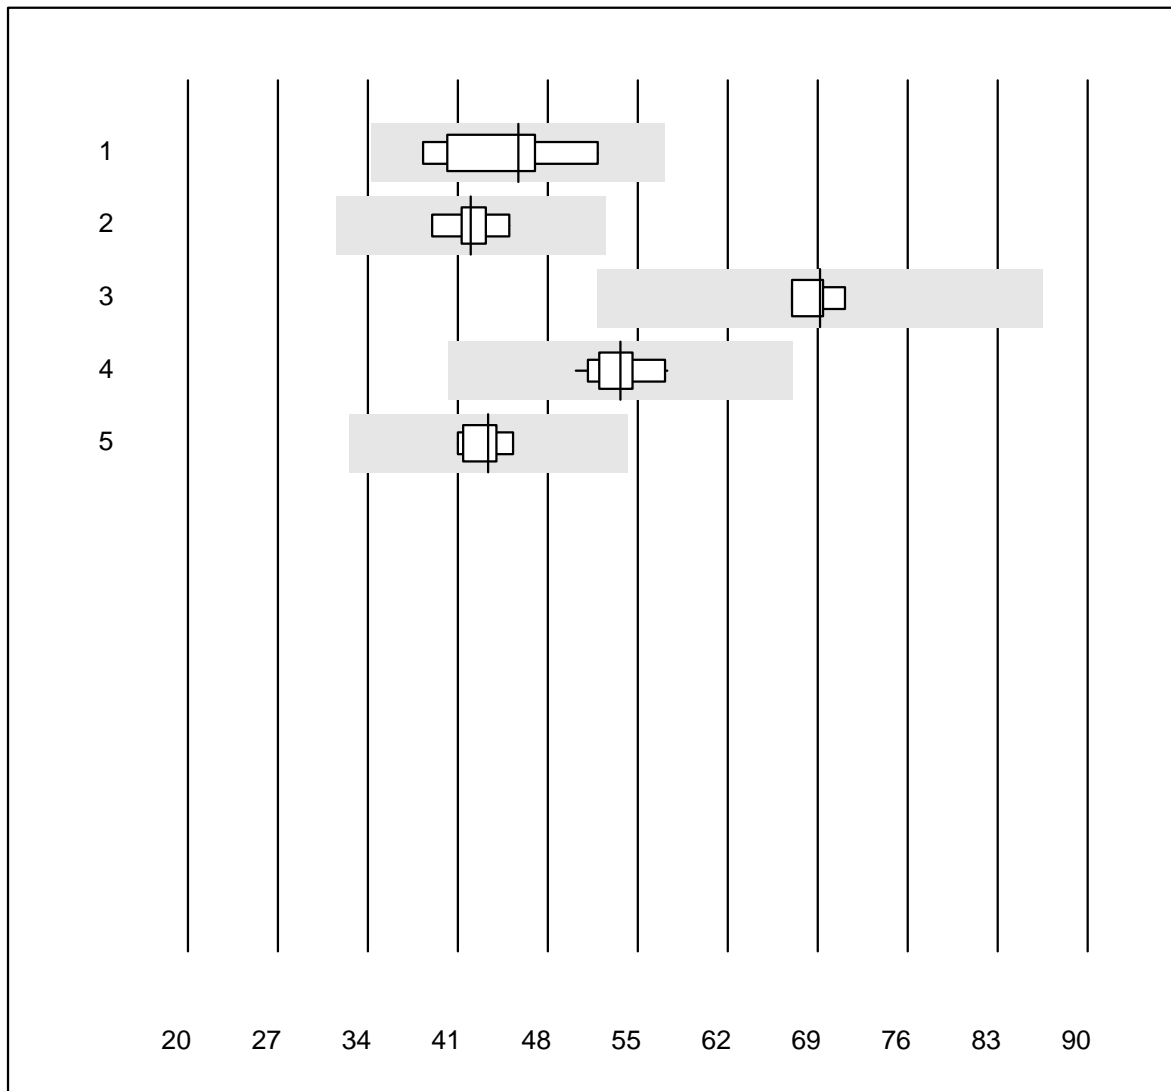


QUALAB Tolérance : 25 %

aPTT OA (Sek)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Autres méthodes	9	100.0	0.0	0.0	45.7	10.6	e*
2 Actin FS	6	100.0	0.0	0.0	42.0	4.7	e
3 Pathromtin SL	4	100.0	0.0	0.0	69.2	2.4	e
4 Stago/STA	14	100.0	0.0	0.0	53.7	4.2	e
5 aPTT-SP	6	100.0	0.0	0.0	43.4	3.8	e

INR CoaguChek

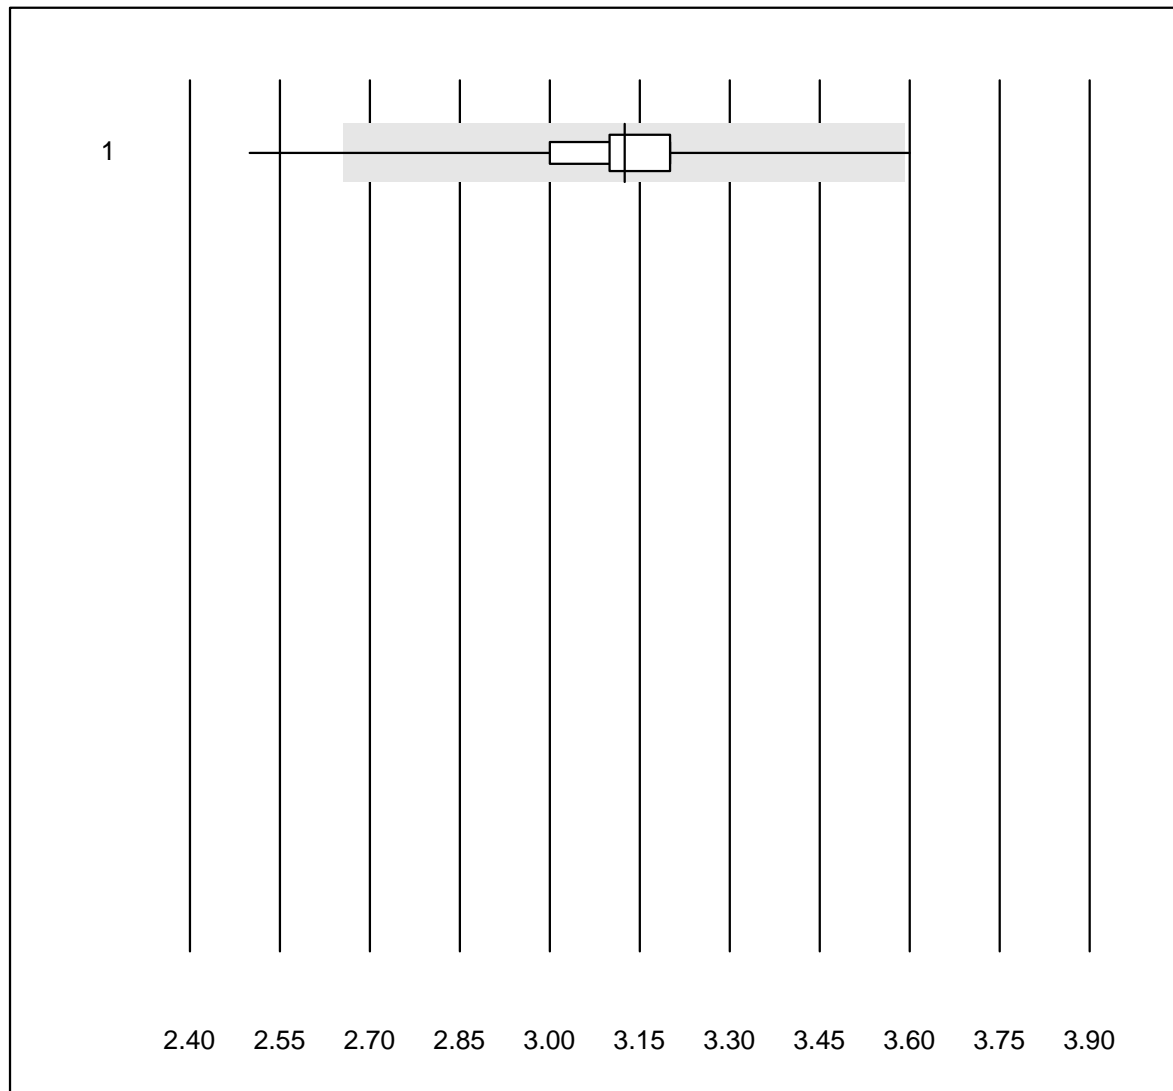


QUALAB Tolérance : 15 %

INR CoaguChek ()

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 CoaguChek Pro II	691	97.7	0.9	1.4	3.1	3.6	e

Quick N

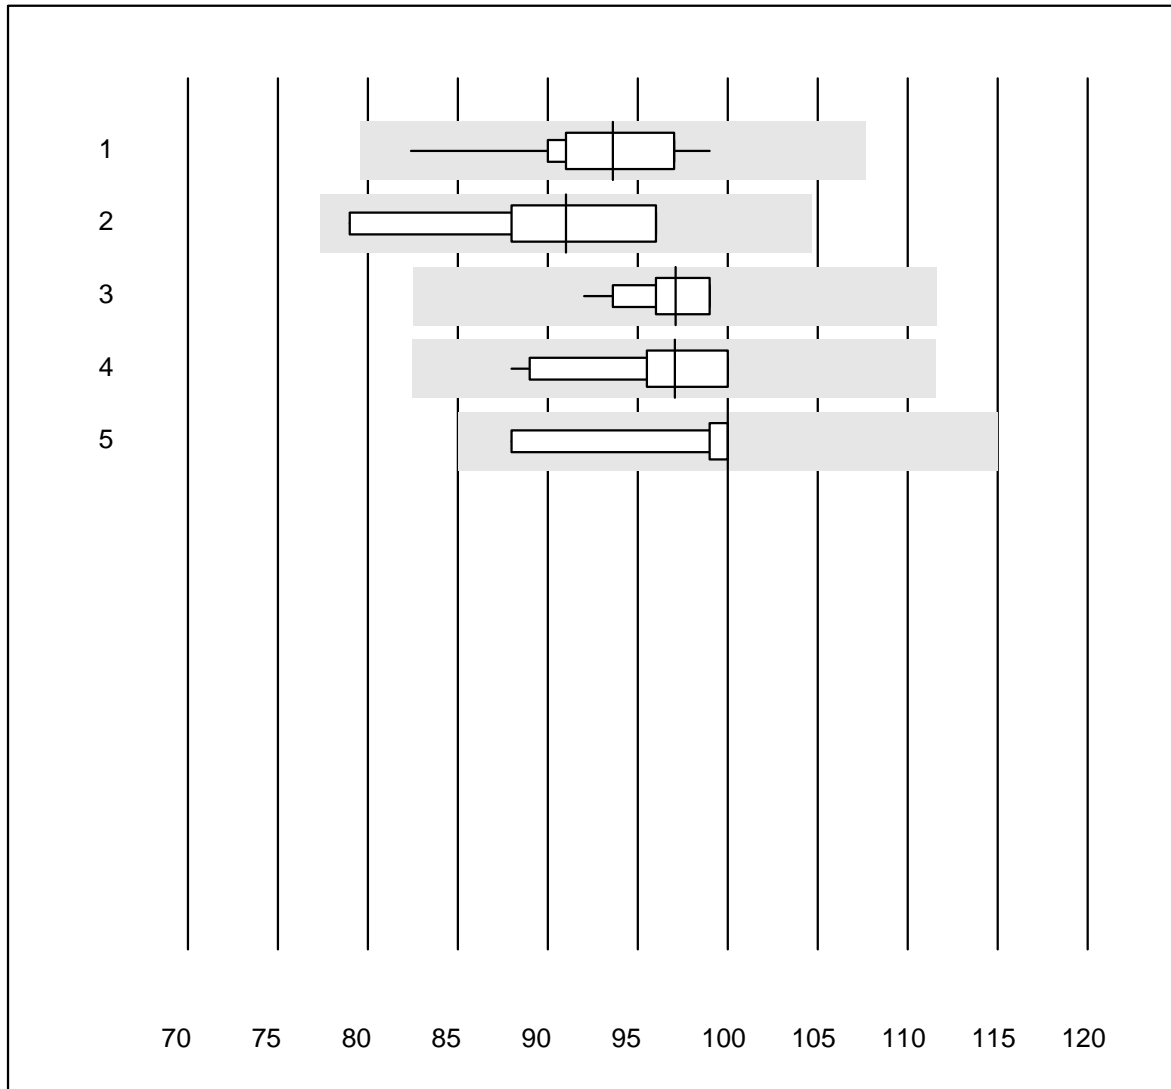


QUALAB Tolérance : 15 %

Quick N (%)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Neoplastin R	12	100.0	0.0	0.0	94	4.8	e
2 Neoplastin Plus	6	100.0	0.0	0.0	91	7.1	e*
3 Innovin	11	100.0	0.0	0.0	97	2.4	e
4 toutes les méthodes	11	100.0	0.0	0.0	97	4.7	e
5 Recombiplastin 2G	8	100.0	0.0	0.0	100	4.3	e

Faktor II

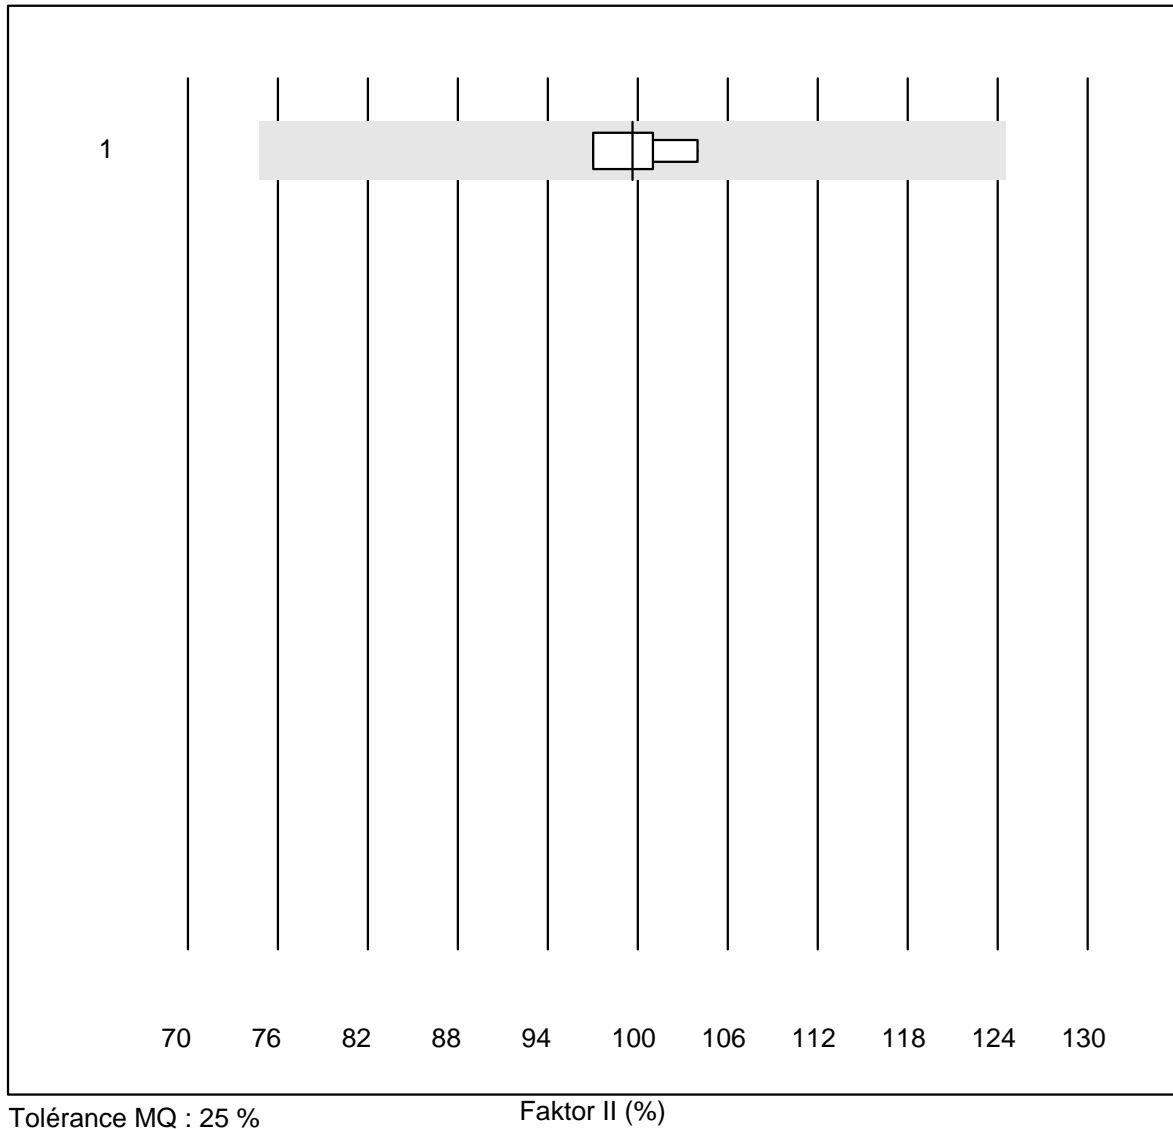

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	99.7	3.1	e

Fibrinogen N

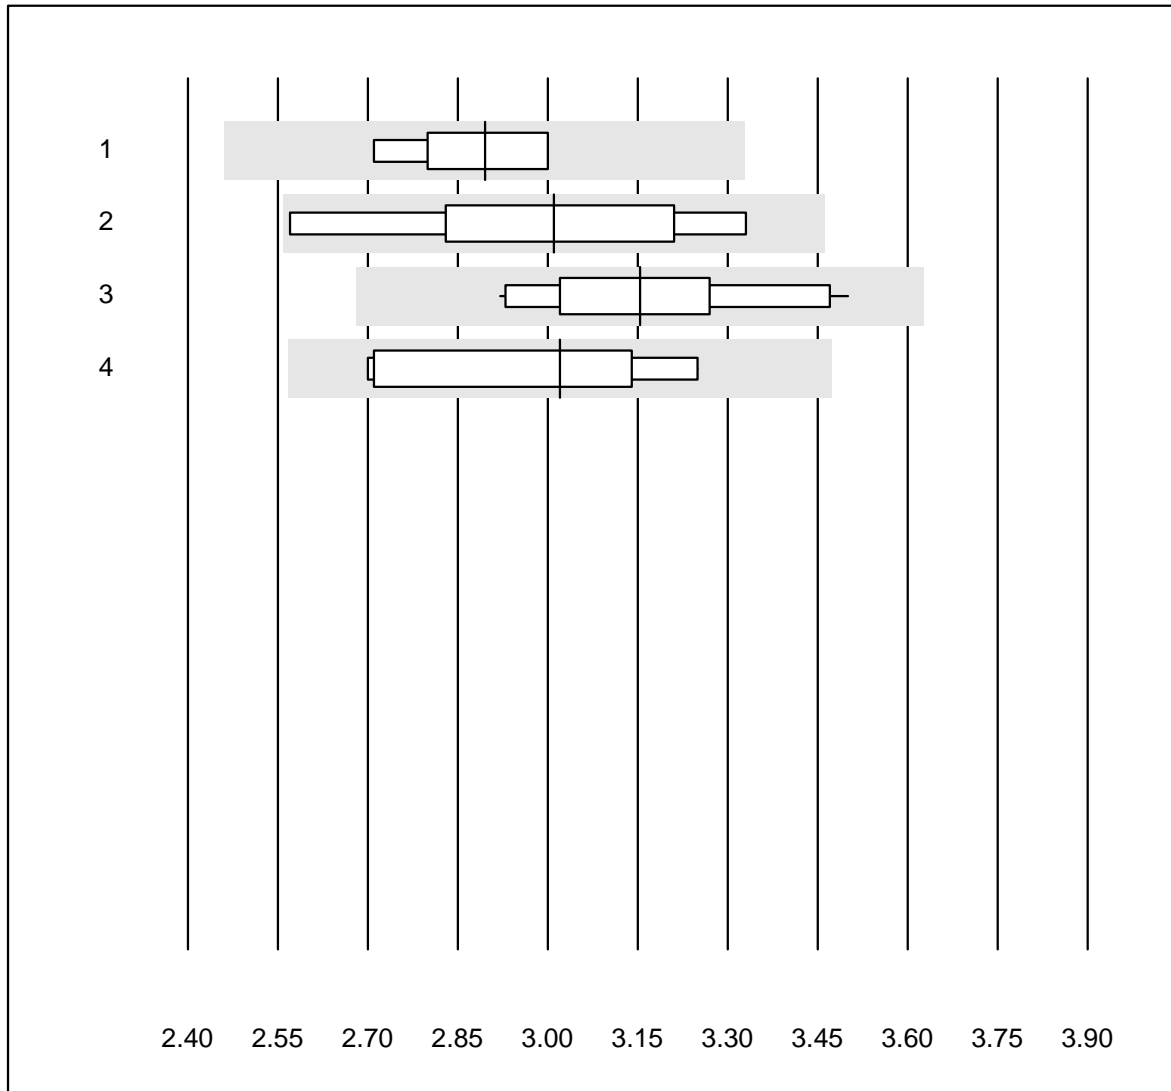


QUALAB Tolérance : 15 %

Fibrinogen N (g/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Siemens Thrombin	6	100.0	0.0	0.0	2.90	4.1	e
2 Autres méthodes	9	88.9	0.0	11.1	3.01	8.4	e*
3 Stago/STA	18	100.0	0.0	0.0	3.15	5.4	e
4 Fibrinogen Q.F.A.	6	100.0	0.0	0.0	3.02	7.7	e*

Faktor V

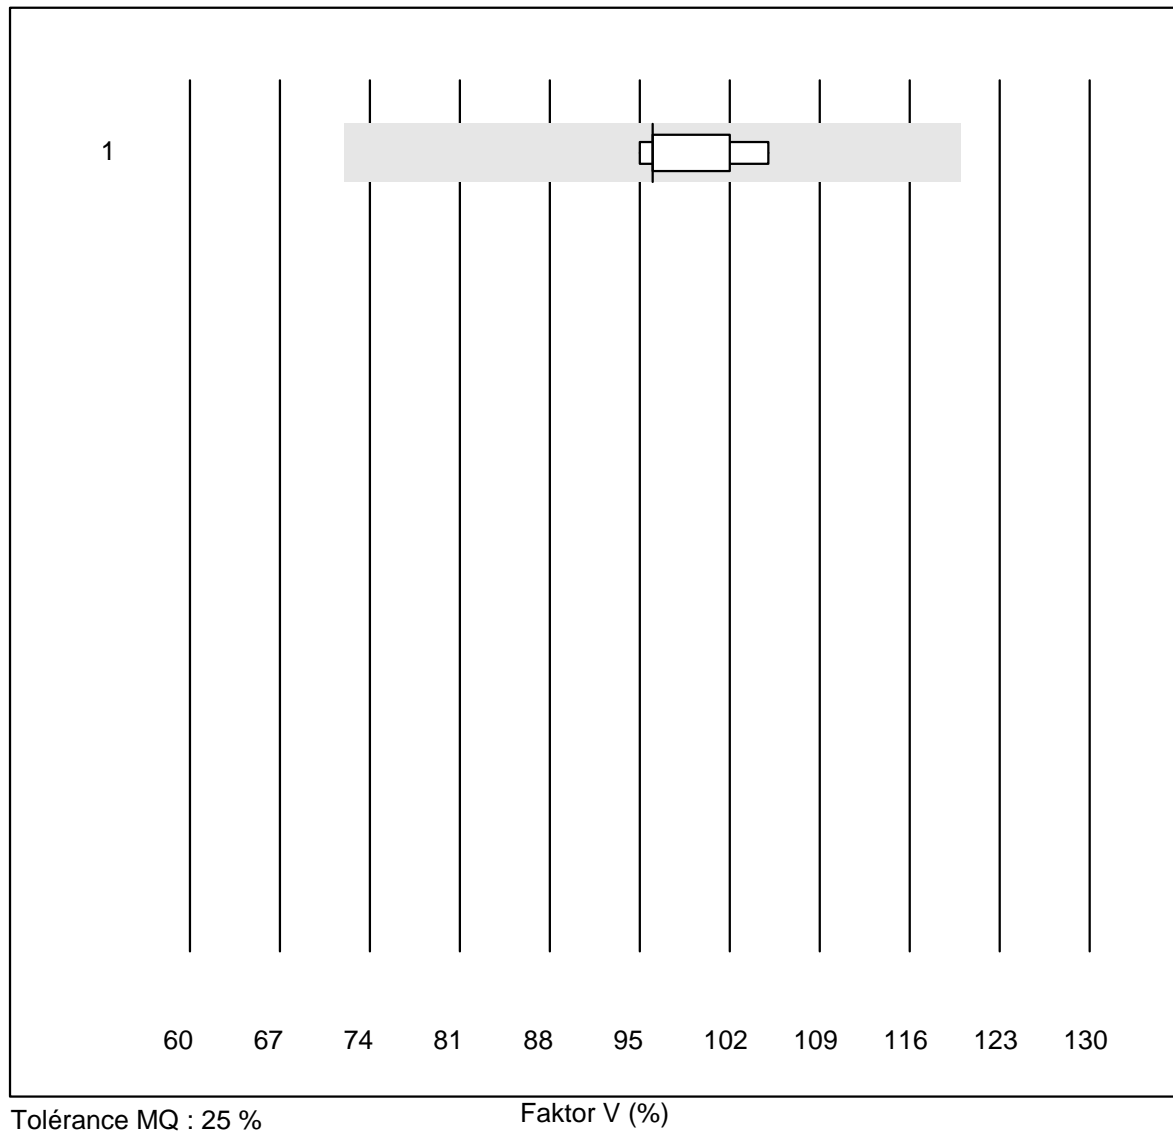

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	7	85.7	0.0	14.3	96.0	4.2	e

aPTT N

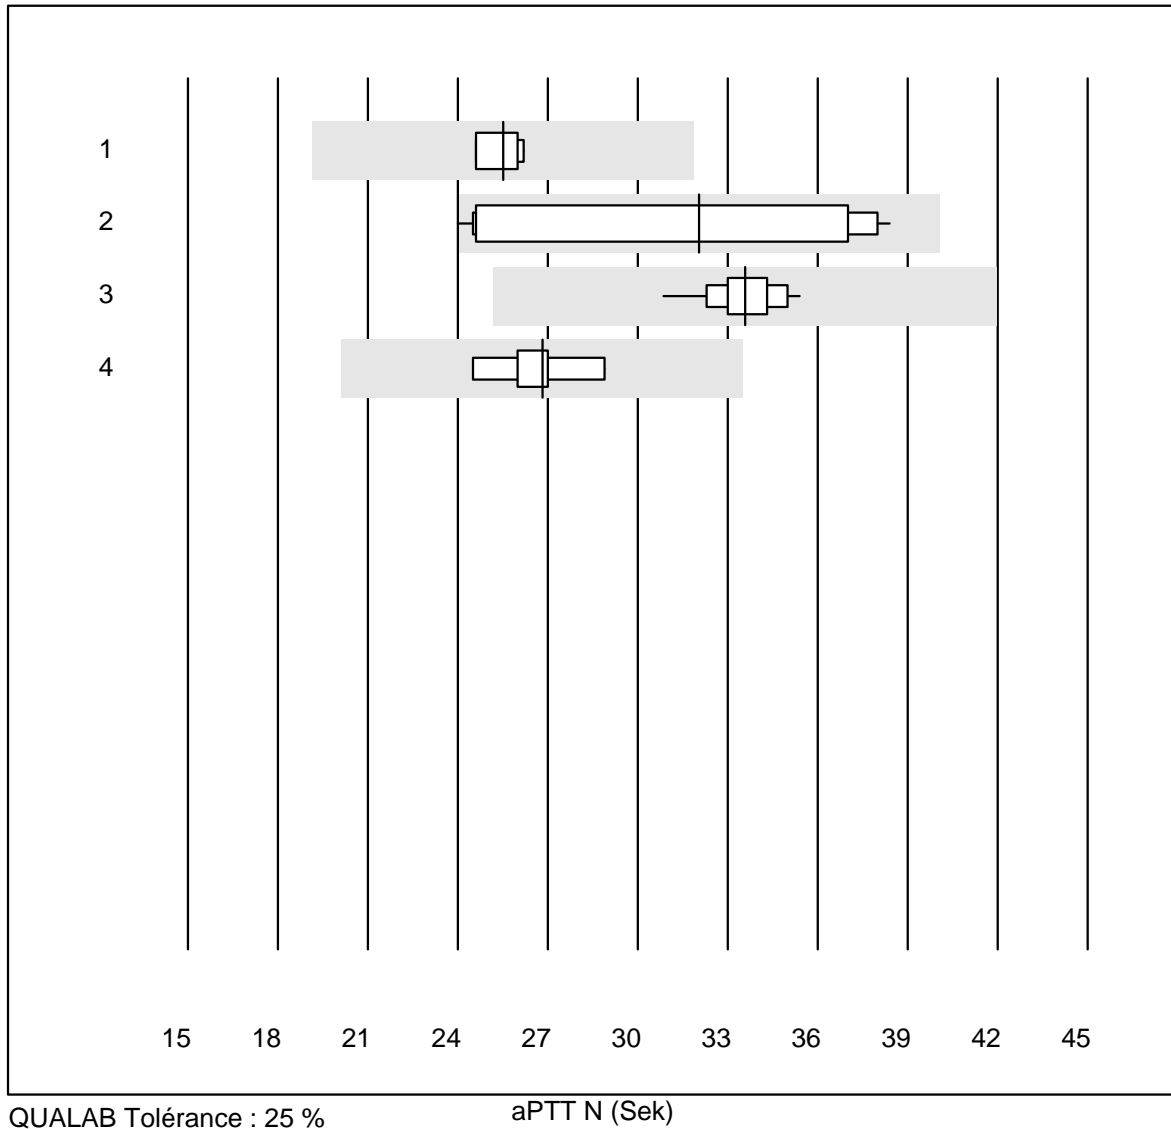


QUALAB Tolérance : 25 %

aPTT N (Sek)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Actin FS	4	100.0	0.0	0.0	25.5	3.0	e
2 Autres méthodes	12	91.7	8.3	0.0	32.1	19.0	e*
3 Stago/STA	17	100.0	0.0	0.0	33.6	3.4	e
4 aPTT-SP	10	80.0	0.0	20.0	26.8	4.9	e

Faktor VII

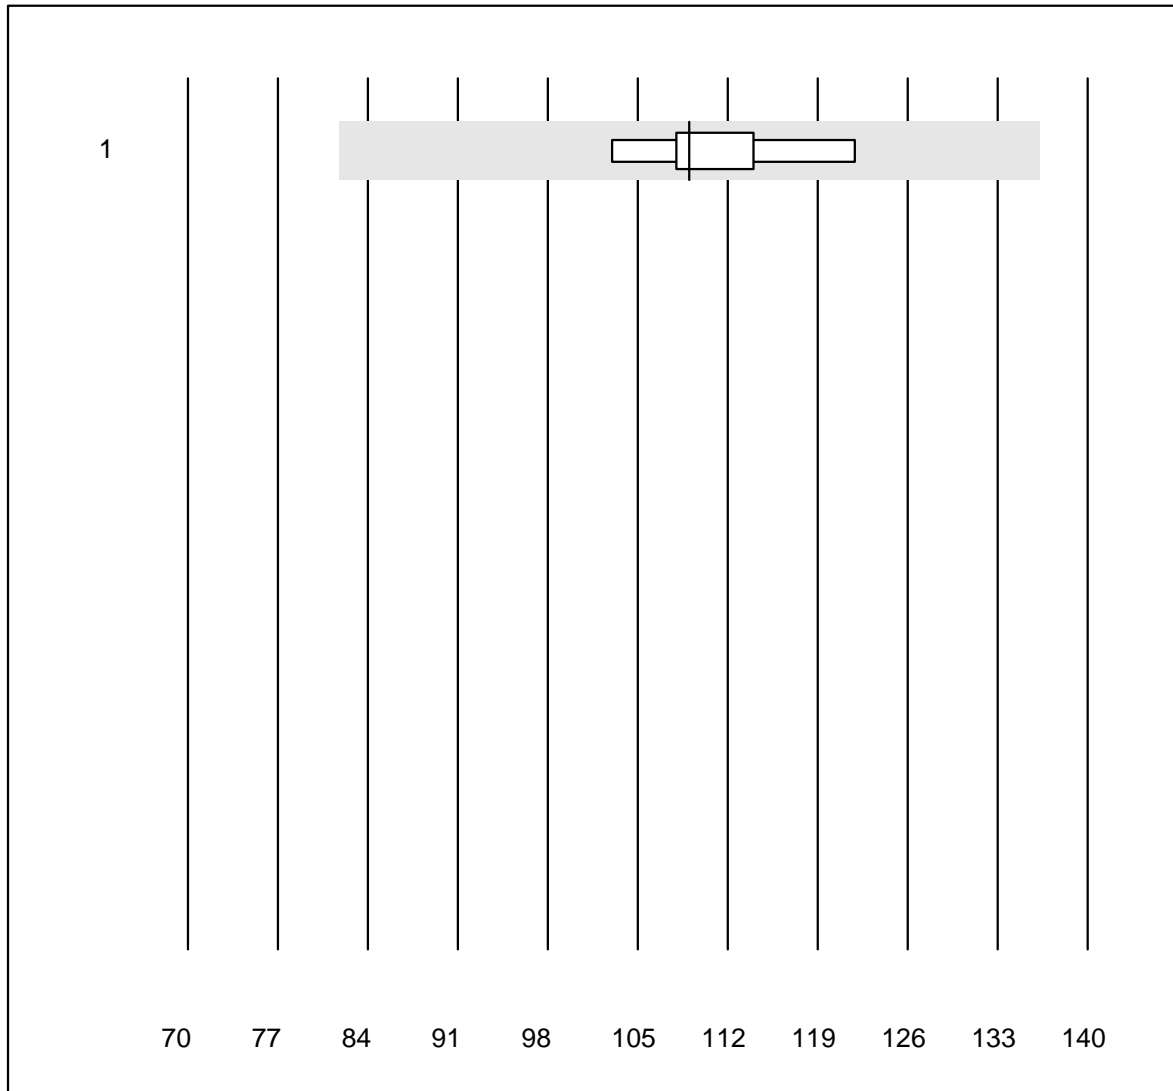


Tolérance MQ : 25 %

Faktor VII (%)


No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	109.0	6.4	e

Quick H

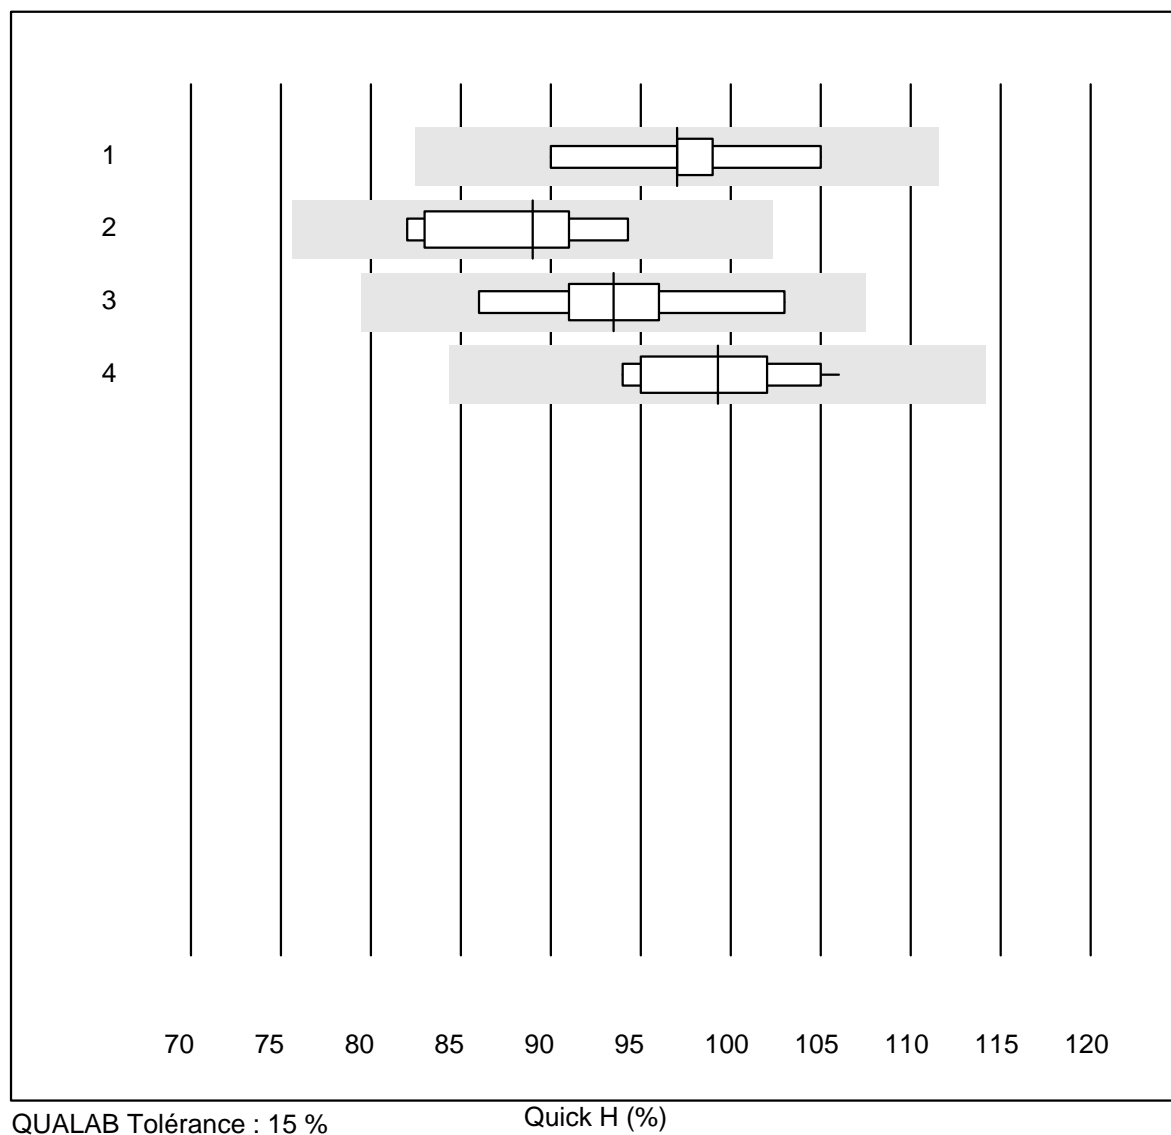

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Neoplastin R	9	100.0	0.0	0.0	97	4.0	e
2 Innovin	9	100.0	0.0	0.0	89	5.4	e*
3 toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	94	6.2	e*
4 Recombiplastin 2G	12	91.7	0.0	8.3	99	4.1	e

Anti-FXa (unfrakt-Heparin)

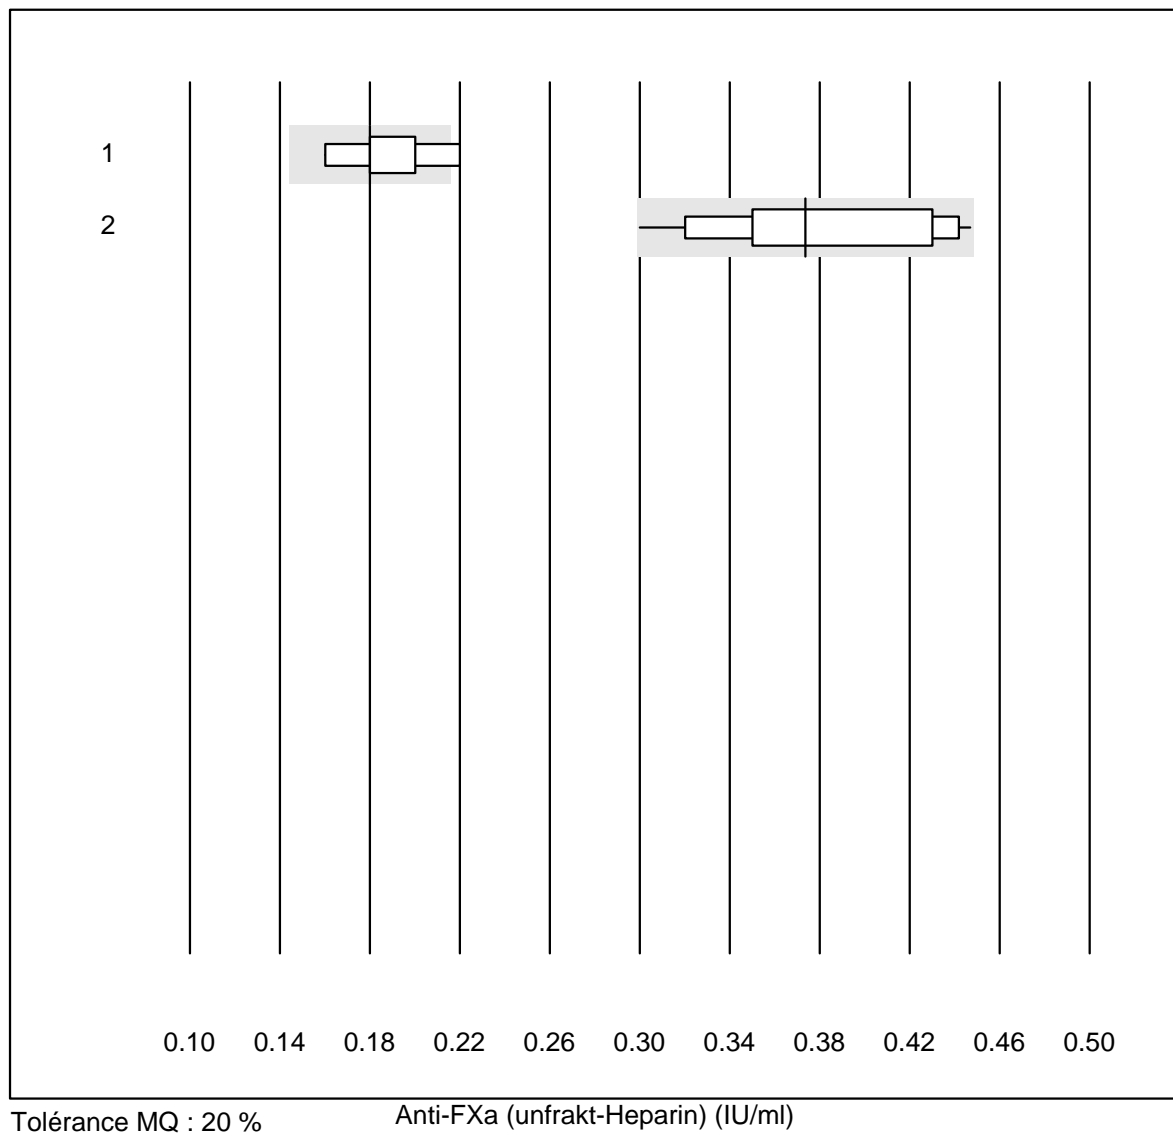


Tolérance MQ : 20 %

Anti-FXa (unfrakt-Heparin) (IU/ml)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Stago/STA	7	85.7	14.3	0.0	0.18	10.1	e*
2 ACL	15	100.0	0.0	0.0	0.37	11.5	a

Fibrinogen H

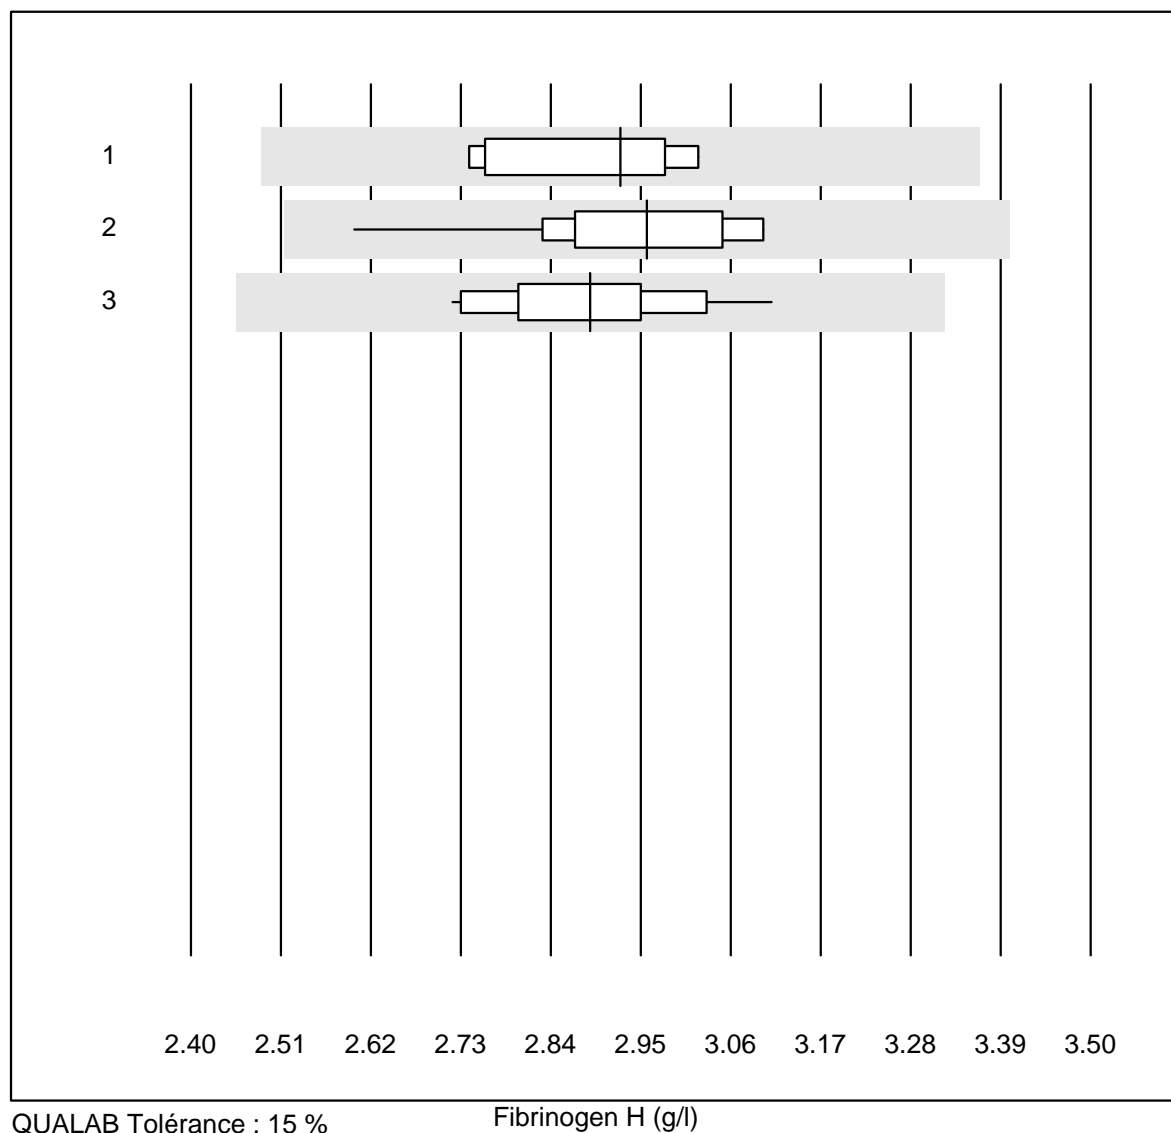


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Autres méthodes	6	100.0	0.0	0.0	2.93	4.0	e
2 Stago/STA	12	100.0	0.0	0.0	2.96	4.9	e
3 Fibrinogen Q.F.A.	12	100.0	0.0	0.0	2.89	4.1	e

aPTT H

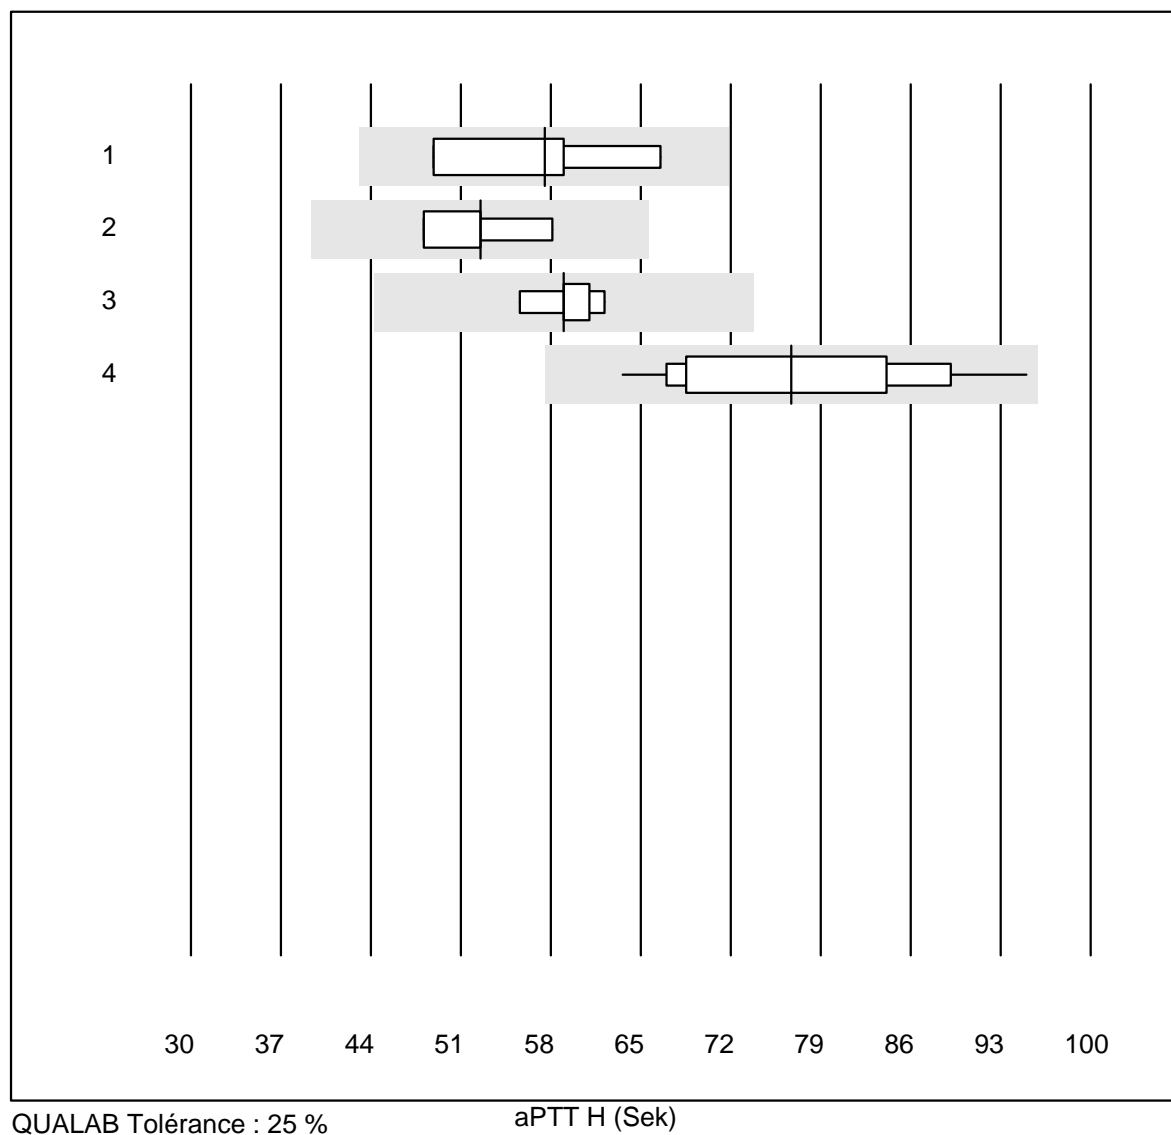


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Actin FS	4	100.0	0.0	0.0	57.5	12.7	e*
2 Autres méthodes	5	80.0	0.0	20.0	52.5	8.0	e*
3 Stago/STA	9	100.0	0.0	0.0	59.0	3.4	e
4 aPTT-SP	12	100.0	0.0	0.0	76.7	13.4	e*

D-Dimères

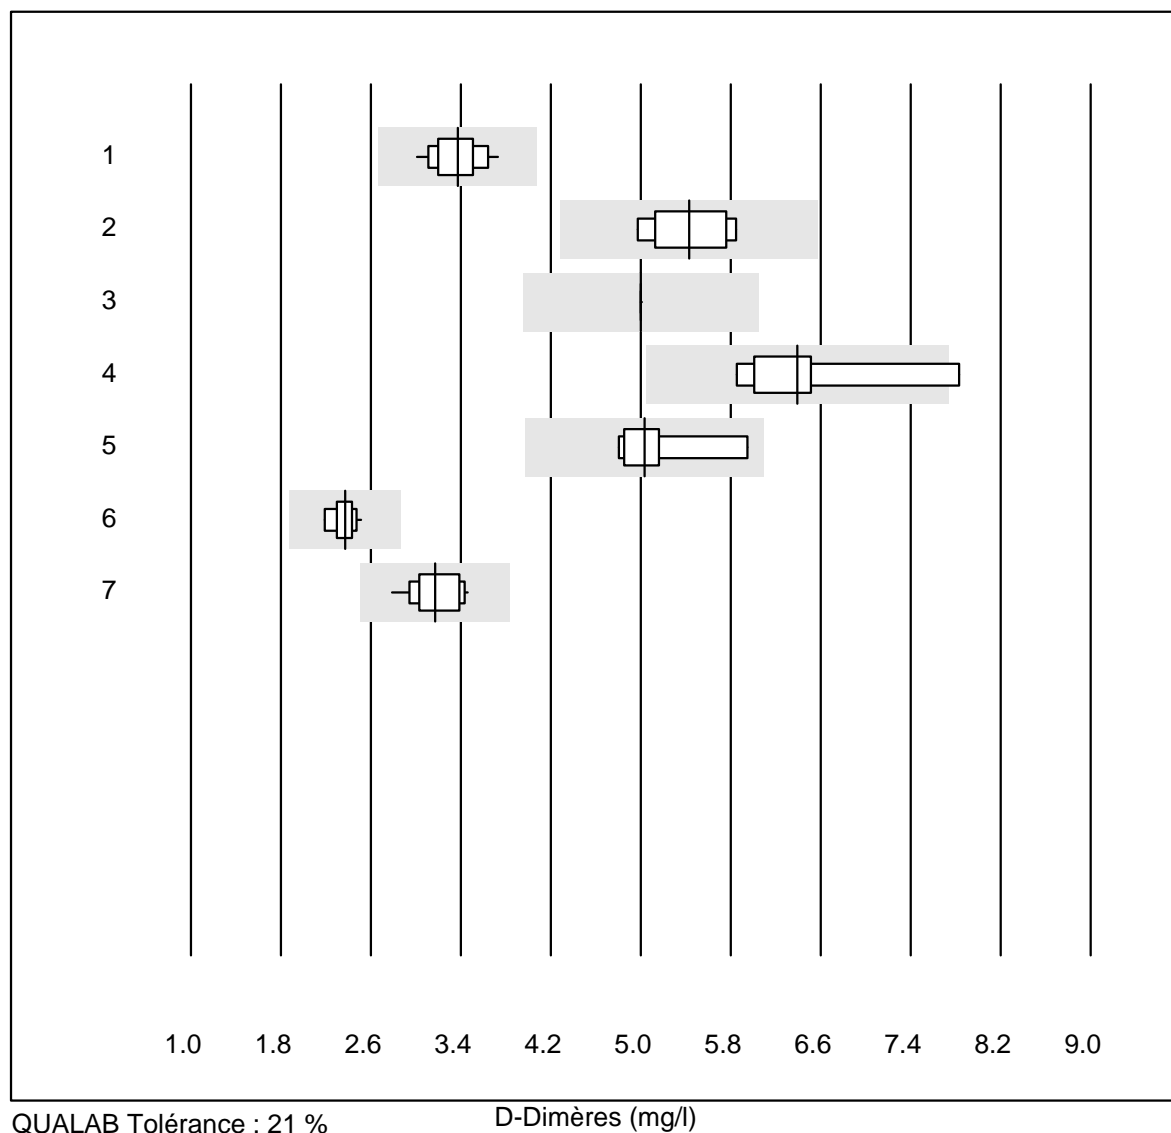


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 STA Liatest	13	100.0	0.0	0.0	3.37	6.1	e
2 Siemens Innovance	6	100.0	0.0	0.0	5.43	6.5	e*
3 Pathfast	8	100.0	0.0	0.0	5.00	0.0	e
4 Eurolyser	5	80.0	20.0	0.0	6.39	12.0	e*
5 ACL	8	100.0	0.0	0.0	5.03	7.6	e*
6 AQT 90 FLEX	10	100.0	0.0	0.0	2.37	3.9	e
7 VIDAS	14	100.0	0.0	0.0	3.17	6.6	e

CoaguChek APTT

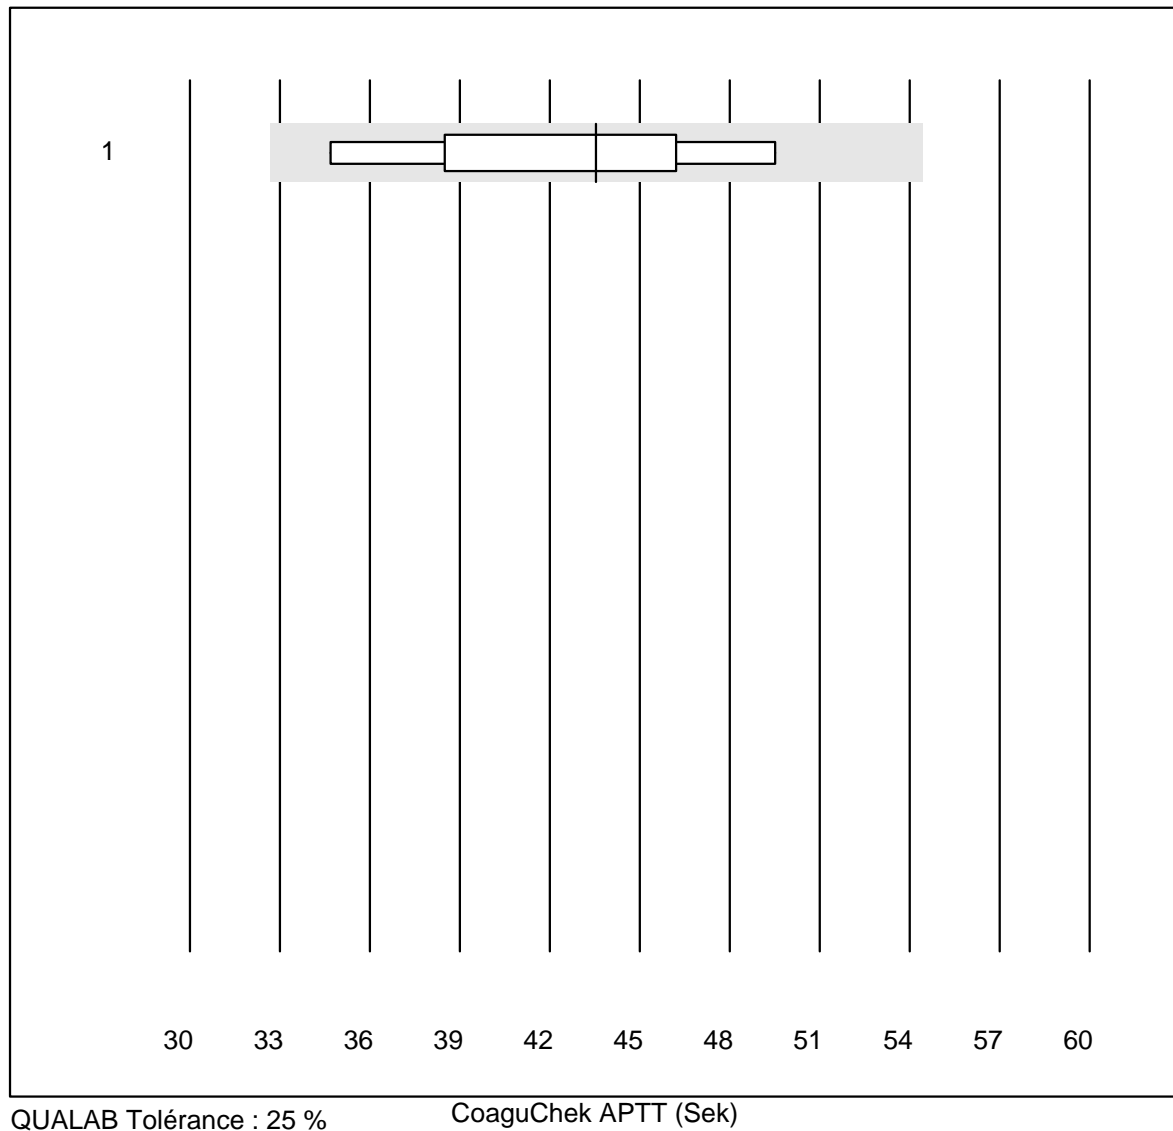

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 CoaguChek Pro II	6	100.0	0.0	0.0	43.6	13.0	e*

INR CCXS

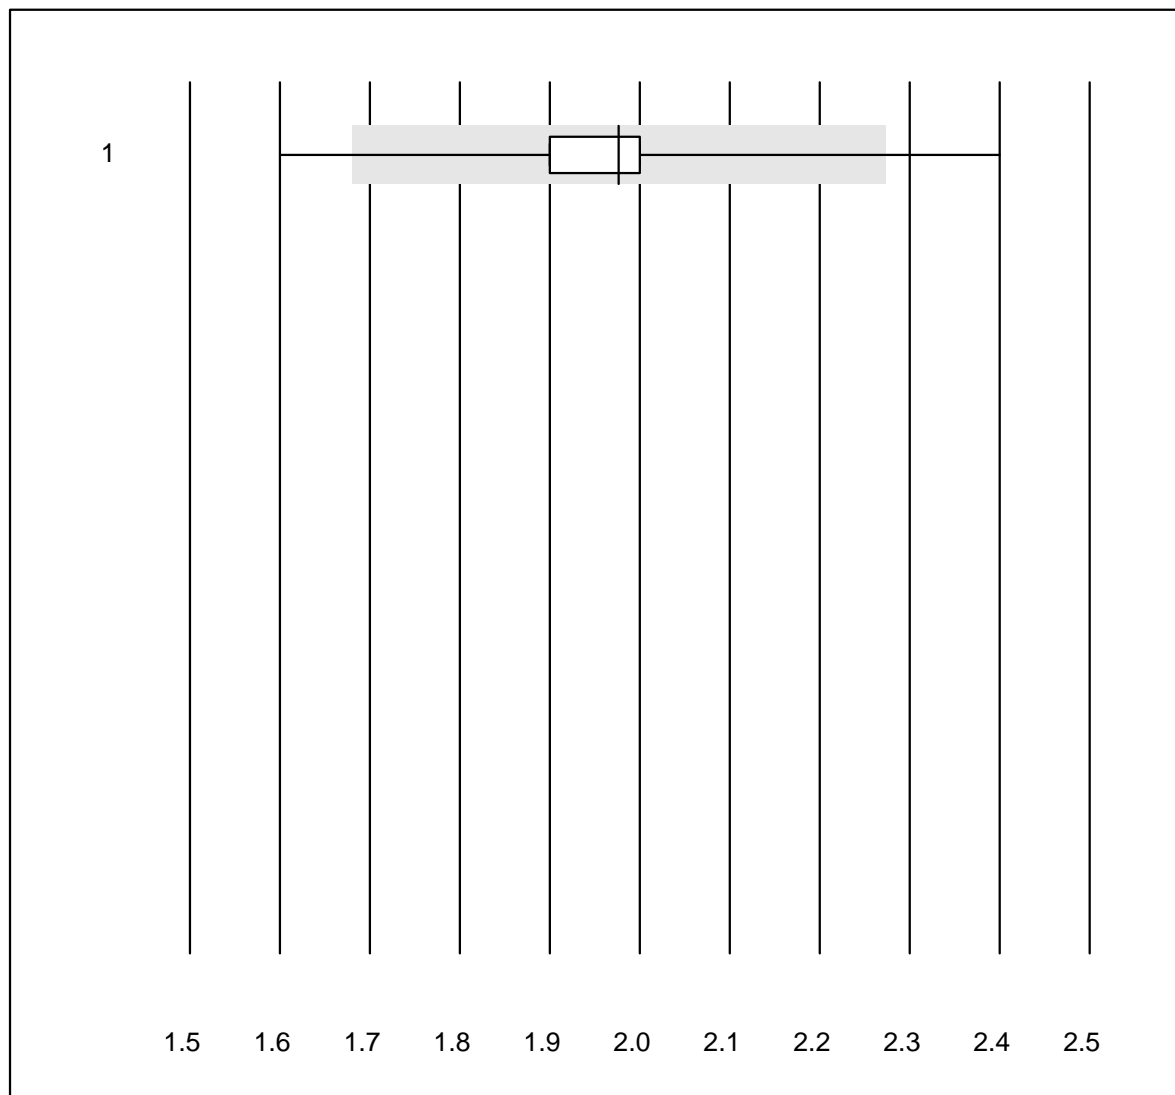


QUALAB Tolérance : 15 %

INR CCXS ()

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 CoaguChek XS	1637	98.9	0.2	0.9	2.0	3.4	e

INR HC

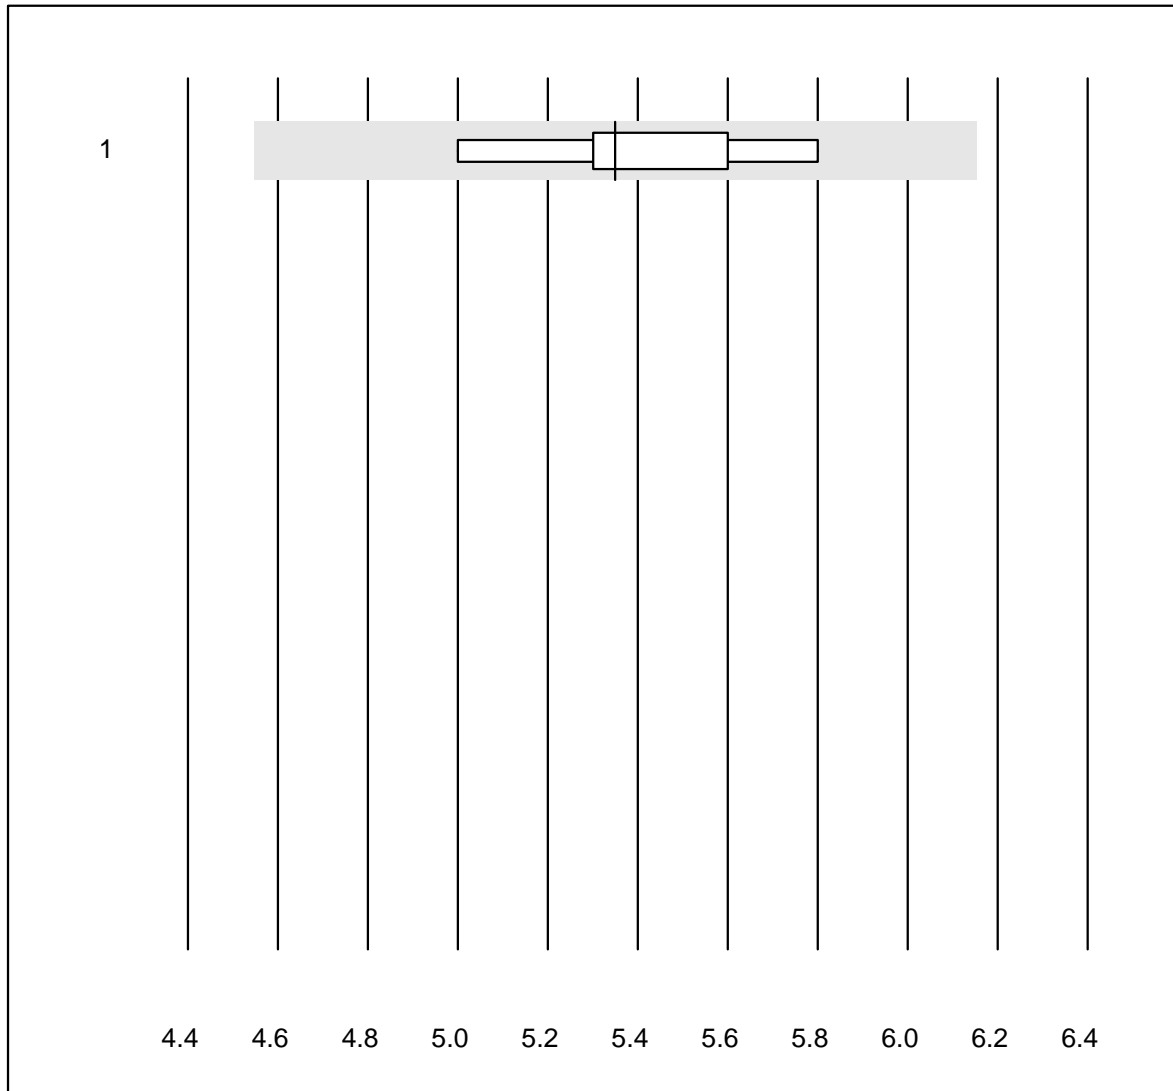


QUALAB Tolérance : 15 %

INR HC ()


No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Hemochron j.	8	100.0	0.0	0.0	5.4	4.6	e

INR MI

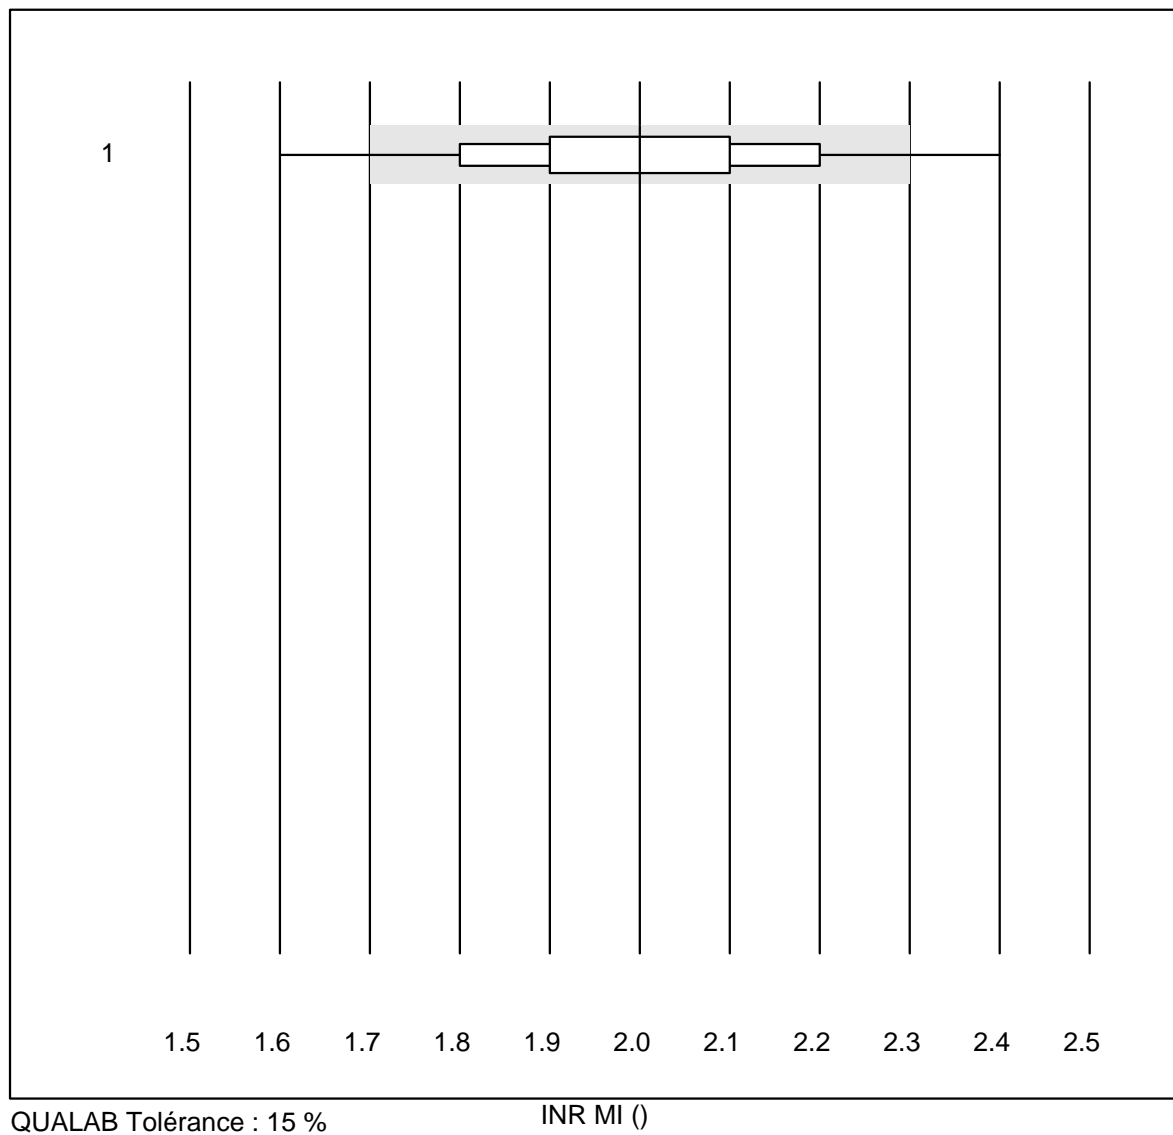

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 MicroINR	130	80.0	8.5	11.5	2.0	7.6	e

INR Xprecia

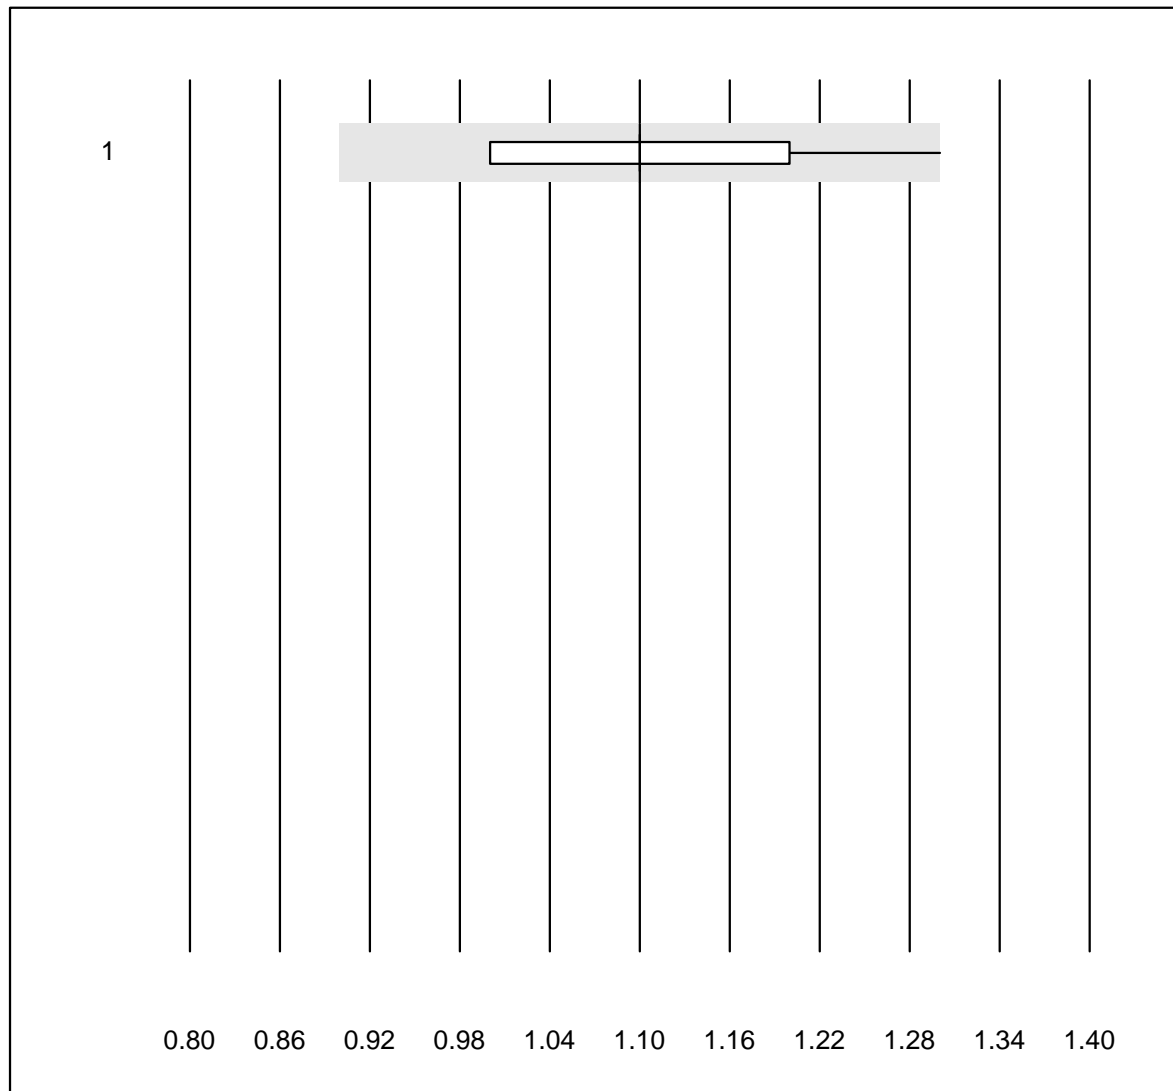


QUALAB Tolérance : 15 %
(< 1.3: +/- 0.2)

INR Xprecia ()

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Xprecia	59	93.2	5.1	1.7	1.1	6.6	e

INR Lumira Dx

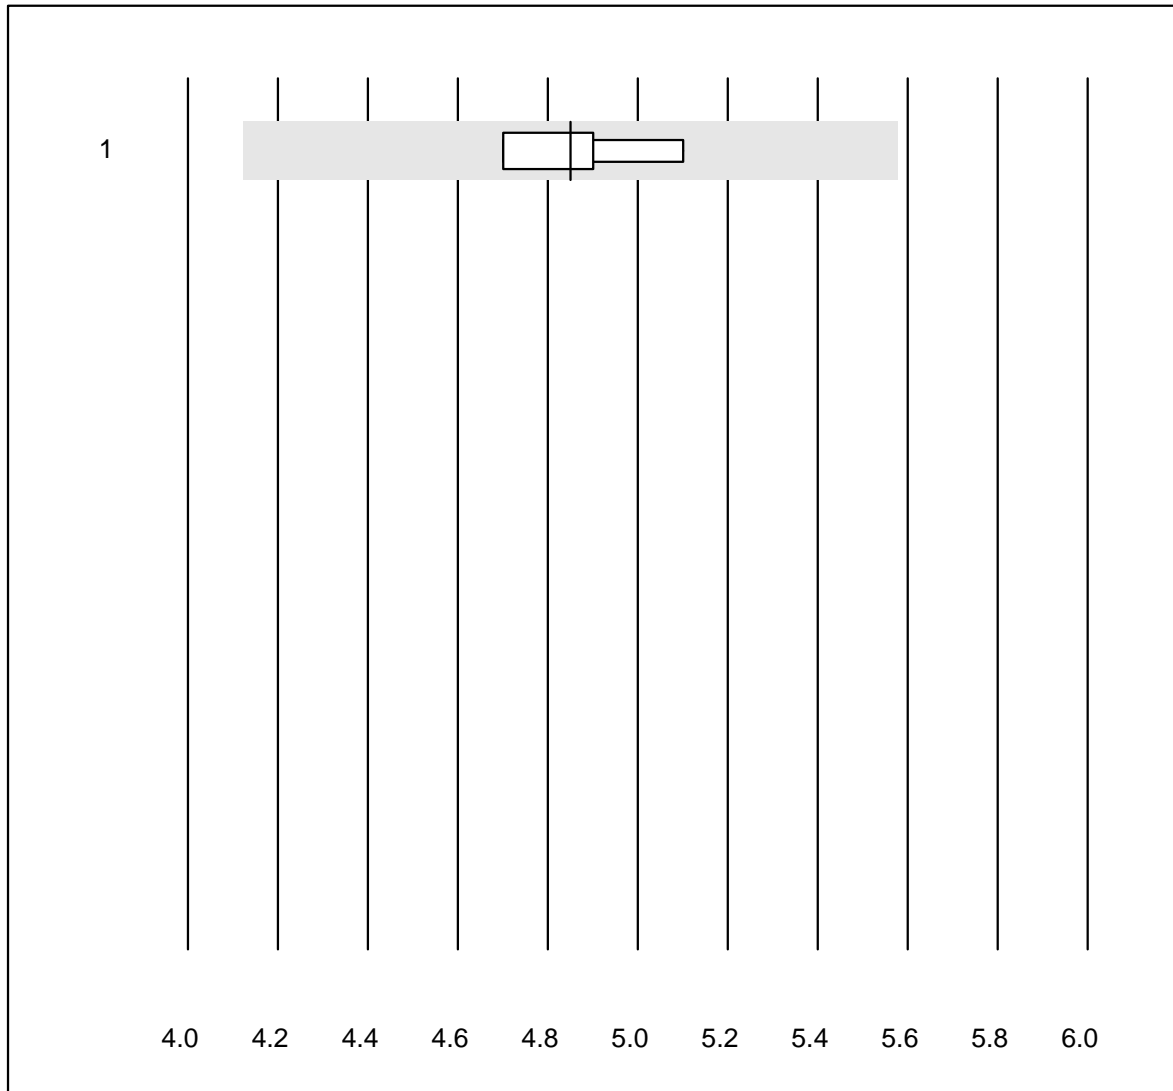


QUALAB Tolérance : 15 %

INR Lumira Dx ()

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Lumira Dx	4	100.0	0.0	0.0	4.9	3.5	e

Anti-FXa (LMW-Heparin)

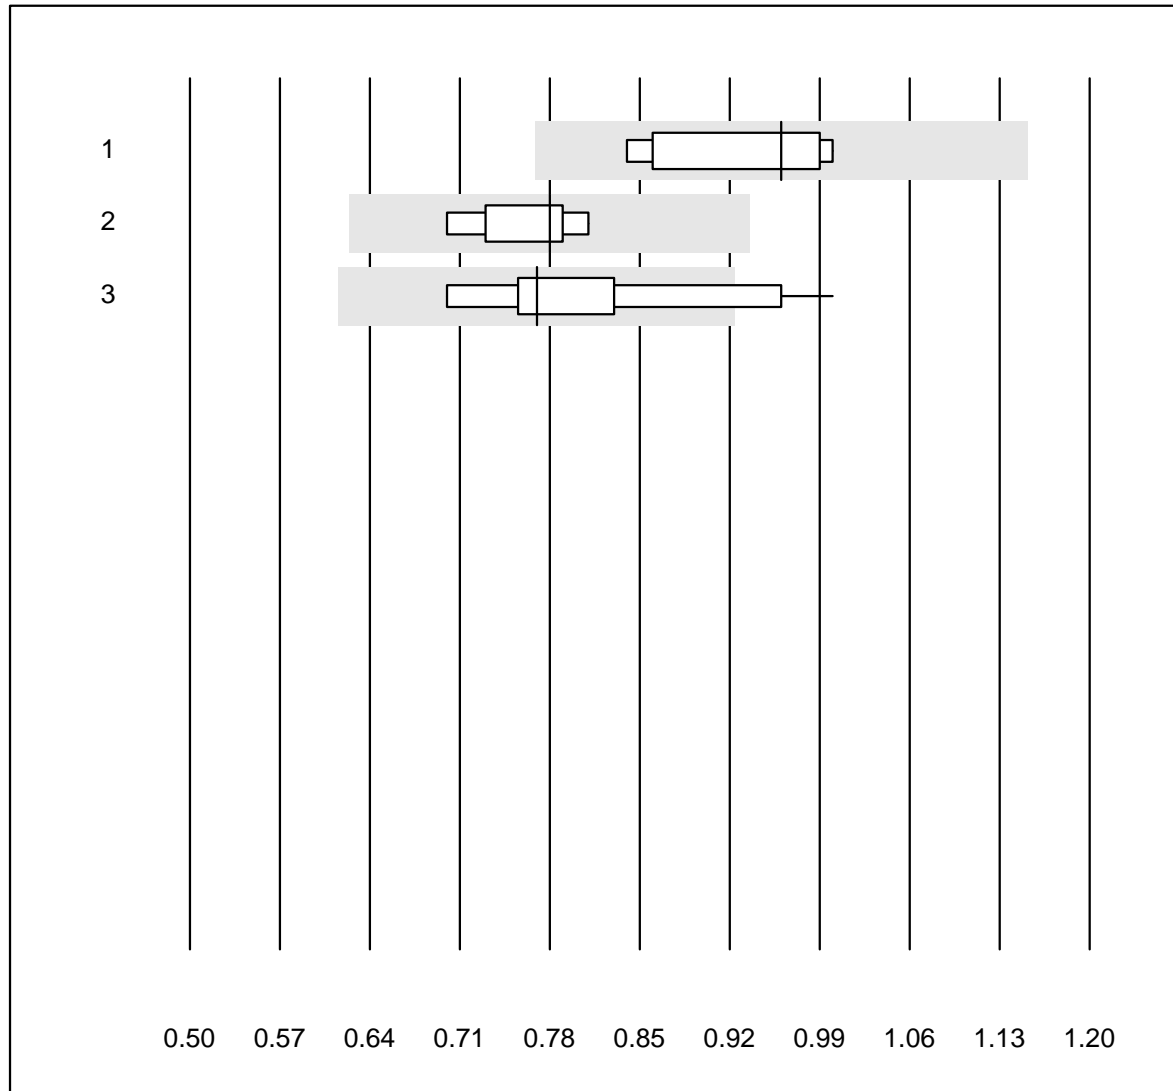


Tolérance MQ : 20 %

Anti-FXa (LMW-Heparin) (IU/ml)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	0.96	6.9	e*
2 Stago/STA	8	100.0	0.0	0.0	0.78	4.8	e
3 ACL	12	66.6	16.7	16.7	0.77	12.6	e*

Anti-FXa (Rivaroxaban)

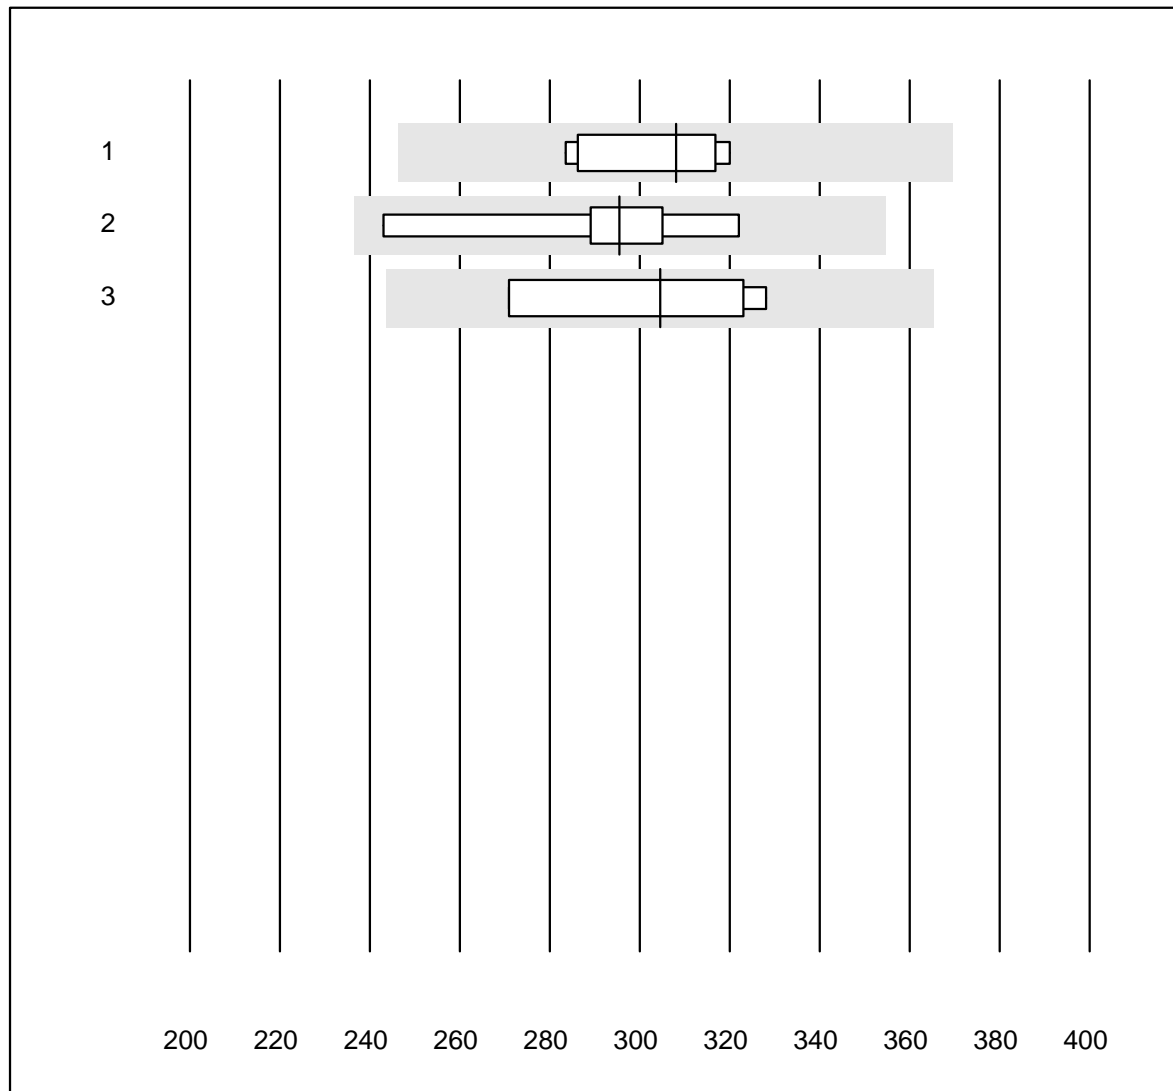


Tolérance MQ : 20 %

Anti-FXa (Rivaroxaban) (µg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	308.00	4.8	e
2 Stago/STA	8	100.0	0.0	0.0	295.50	7.8	e*
3 ACL	4	100.0	0.0	0.0	304.55	9.2	e*

Anti-FXa (Apixaban)

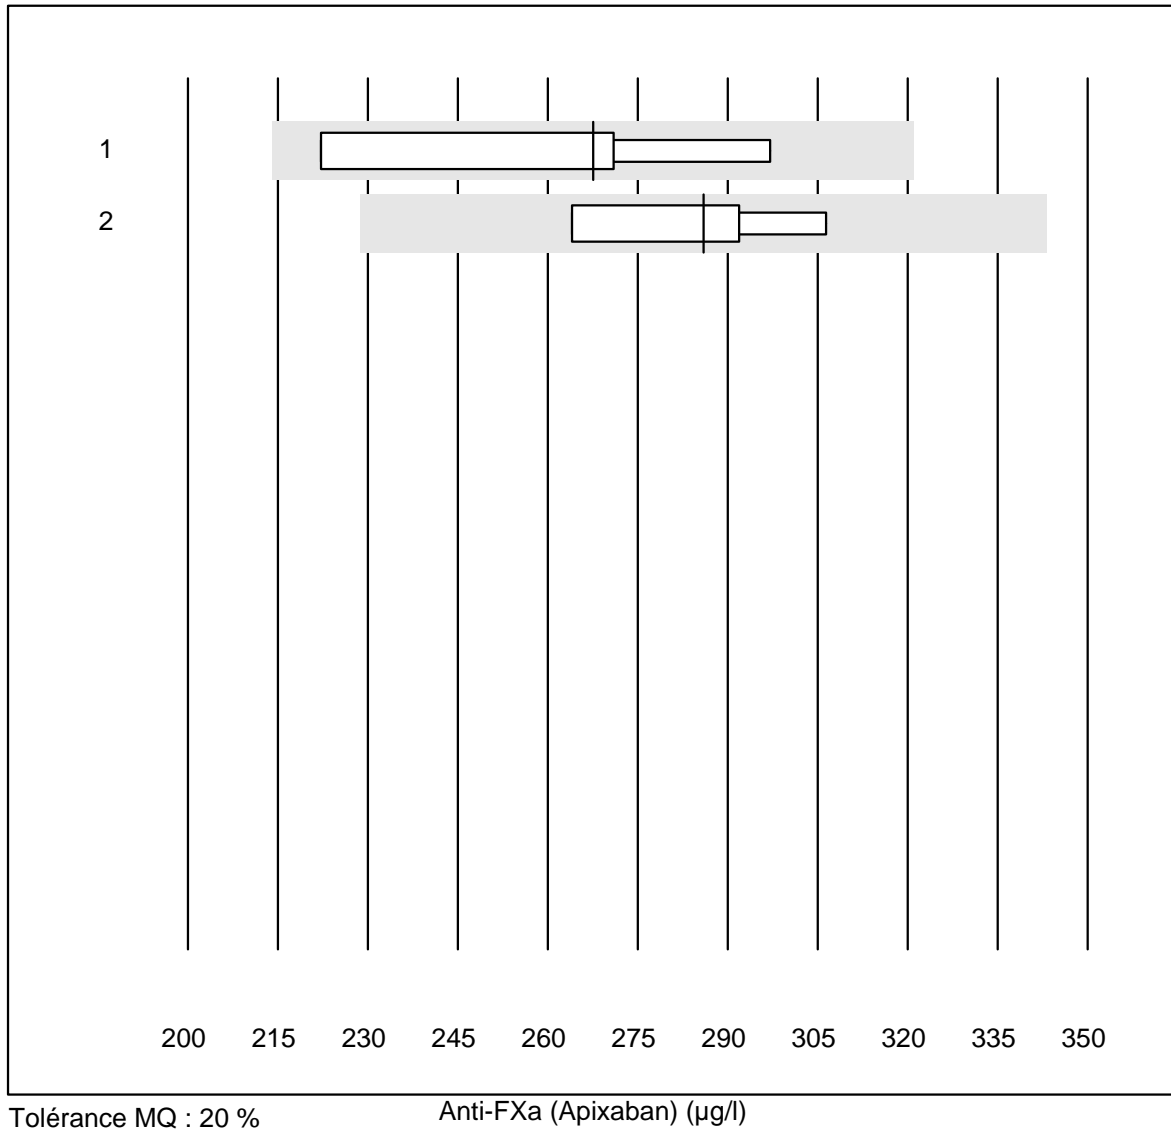


Tolérance MQ : 20 %

Anti-FXa (Apixaban) (µg/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	267.50	11.8	e*
2 ACL	4	100.0	0.0	0.0	285.95	6.3	e*

Hémoglobine

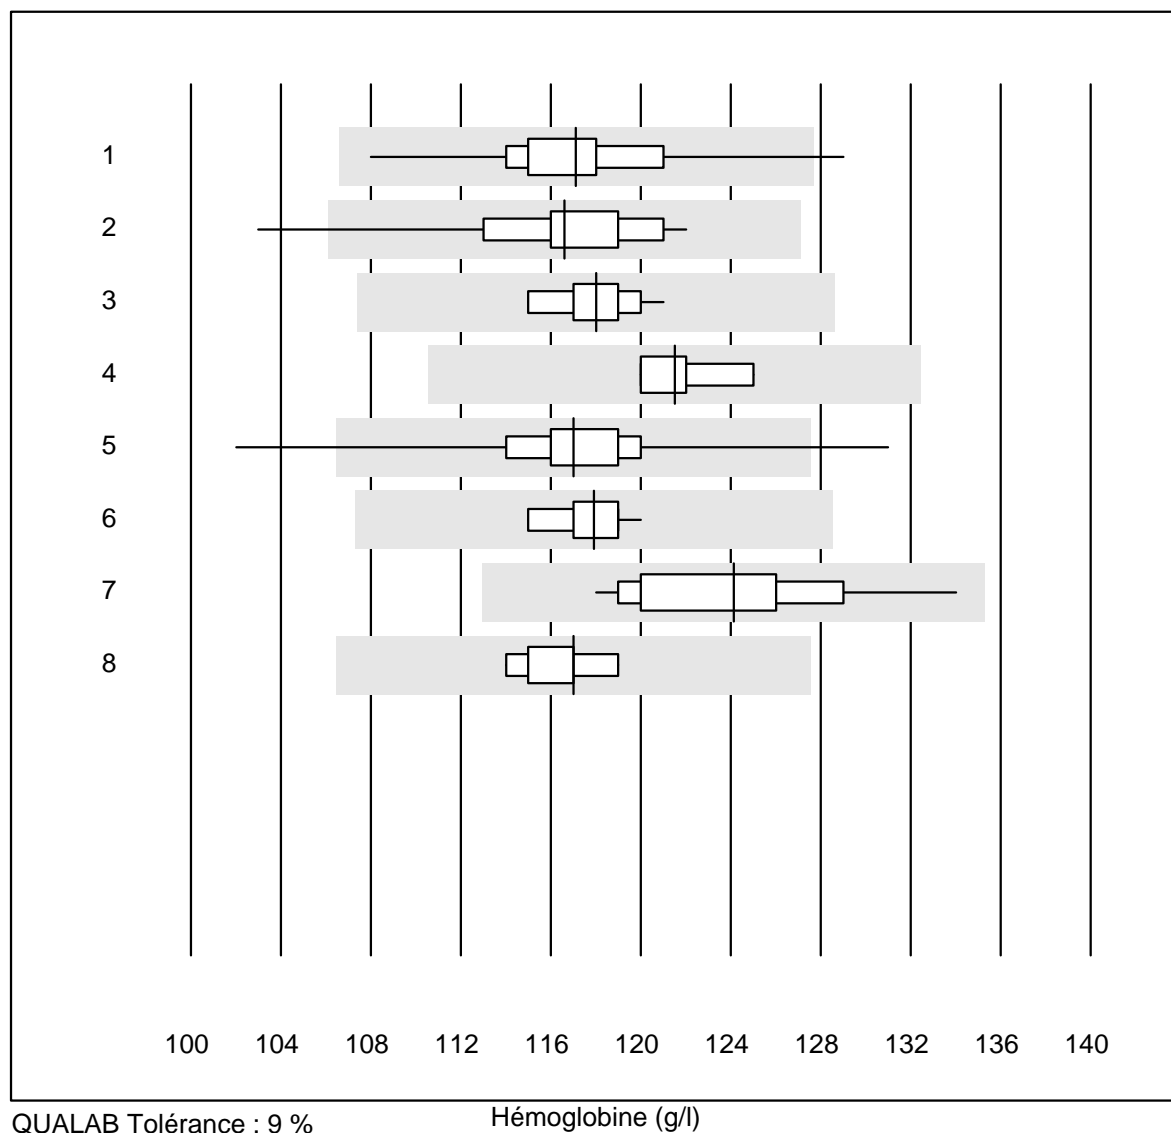

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Automate	16	93.7	6.3	0.0	117.1	3.7	e
2 Cyanmethémoglobine	21	95.2	4.8	0.0	116.6	3.5	e
3 Sysmex X	45	97.8	0.0	2.2	118.0	1.5	e
4 Advia 120	4	100.0	0.0	0.0	121.5	1.8	e
5 Hemocue	415	94.2	1.7	4.1	117.0	2.5	e
6 Hemocontrol	10	100.0	0.0	0.0	117.9	1.4	e
7 DiaSpect	16	100.0	0.0	0.0	124.1	3.4	e
8 Sysmex	9	100.0	0.0	0.0	117.0	1.3	e

Hémoglobine

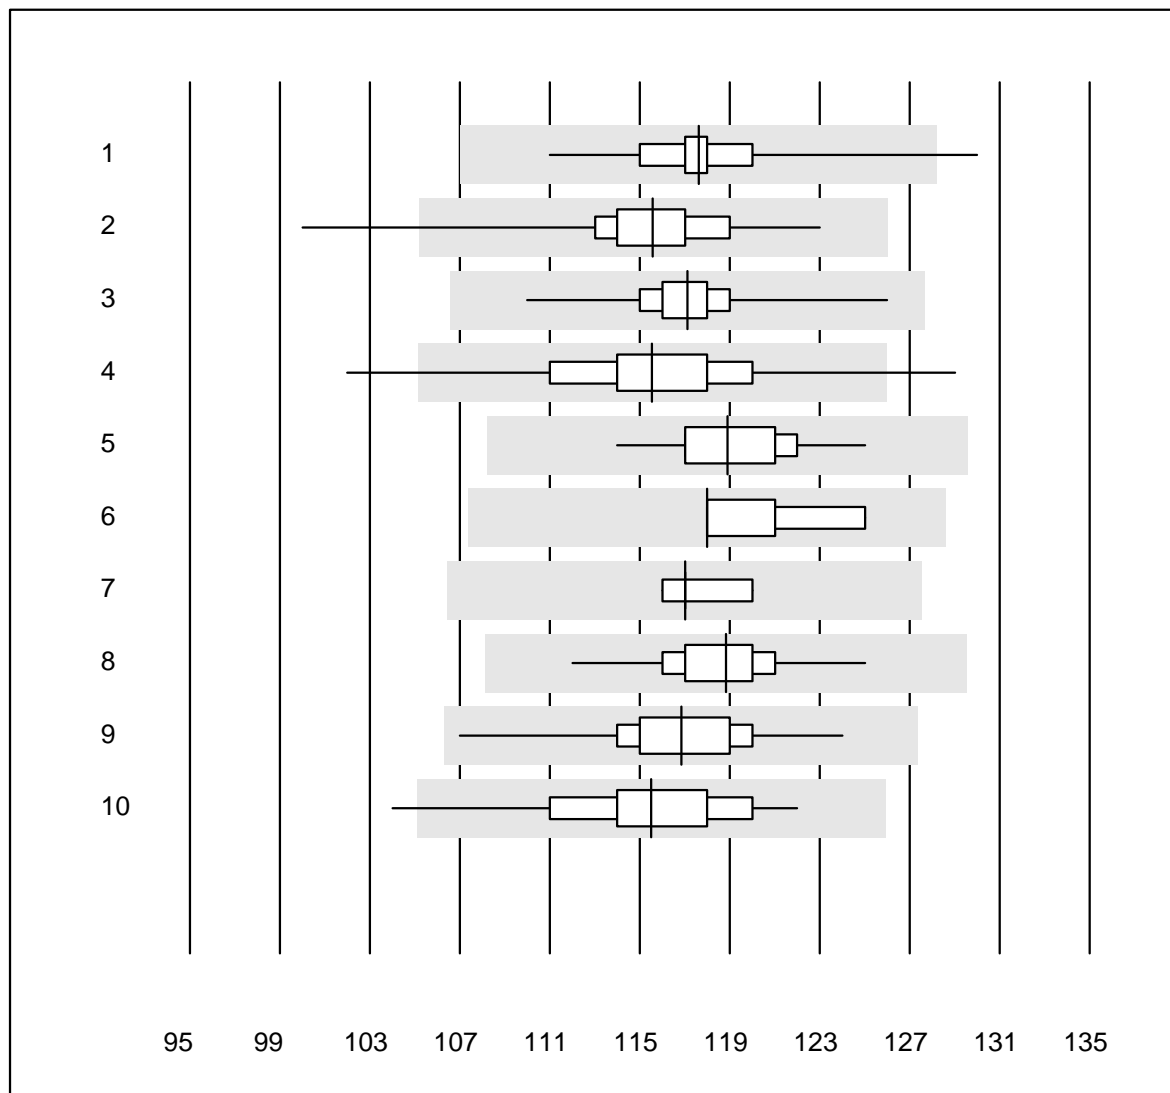


QUALAB Tolérance : 9 %

Hémoglobine (g/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex KX21	206	98.5	0.5	1.0	117.6	1.8	e
2 Sysmex Poch - 100i	198	98.0	1.5	0.5	115.6	2.5	e
3 Sysmex XP 300	599	97.5	0.0	2.5	117.1	1.2	e
4 Mythic	273	96.4	1.8	1.8	115.5	3.0	e
5 Swelab	32	96.9	0.0	3.1	118.9	2.1	e
6 Abacus Junior	5	100.0	0.0	0.0	118.0	2.6	e*
7 Medonic	6	83.3	0.0	16.7	117.0	1.3	e
8 Celltac Alpha (Nihon)	85	97.6	0.0	2.4	118.8	1.9	e
9 Samsung HC10	26	100.0	0.0	0.0	116.8	2.7	e
10 Micros 60	106	98.2	0.9	0.9	115.5	2.9	e

Hématocrite

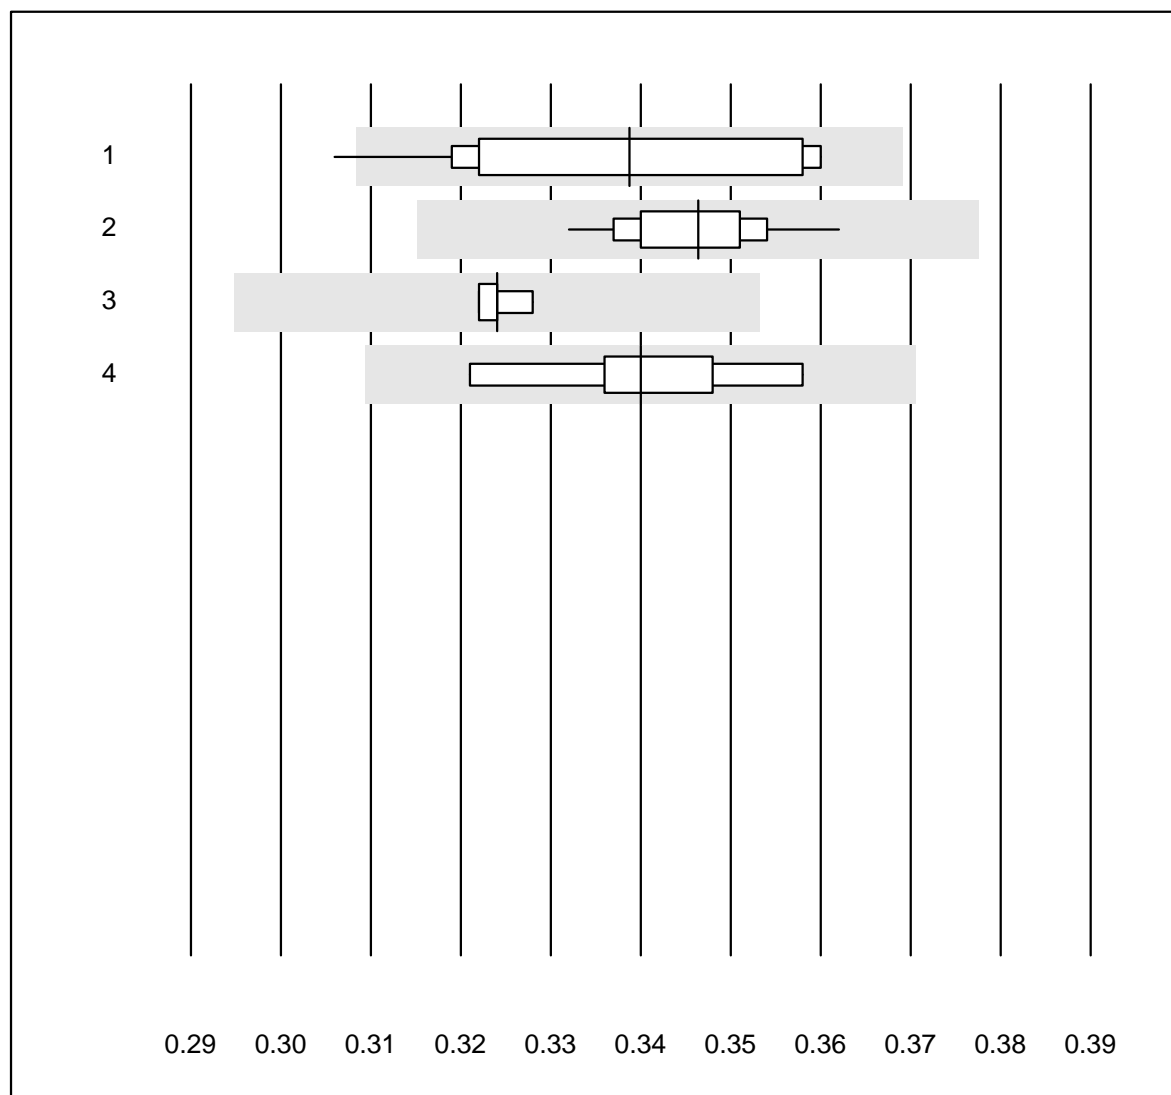


QUALAB Tolérance : 9 %

Hématocrite (l/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Automate	16	93.7	6.3	0.0	0.34	5.3	e*
2 Sysmex X	45	95.6	0.0	4.4	0.35	1.9	e
3 Advia 120	4	100.0	0.0	0.0	0.32	0.8	e
4 Sysmex	9	100.0	0.0	0.0	0.34	3.5	e*

Hématocrite

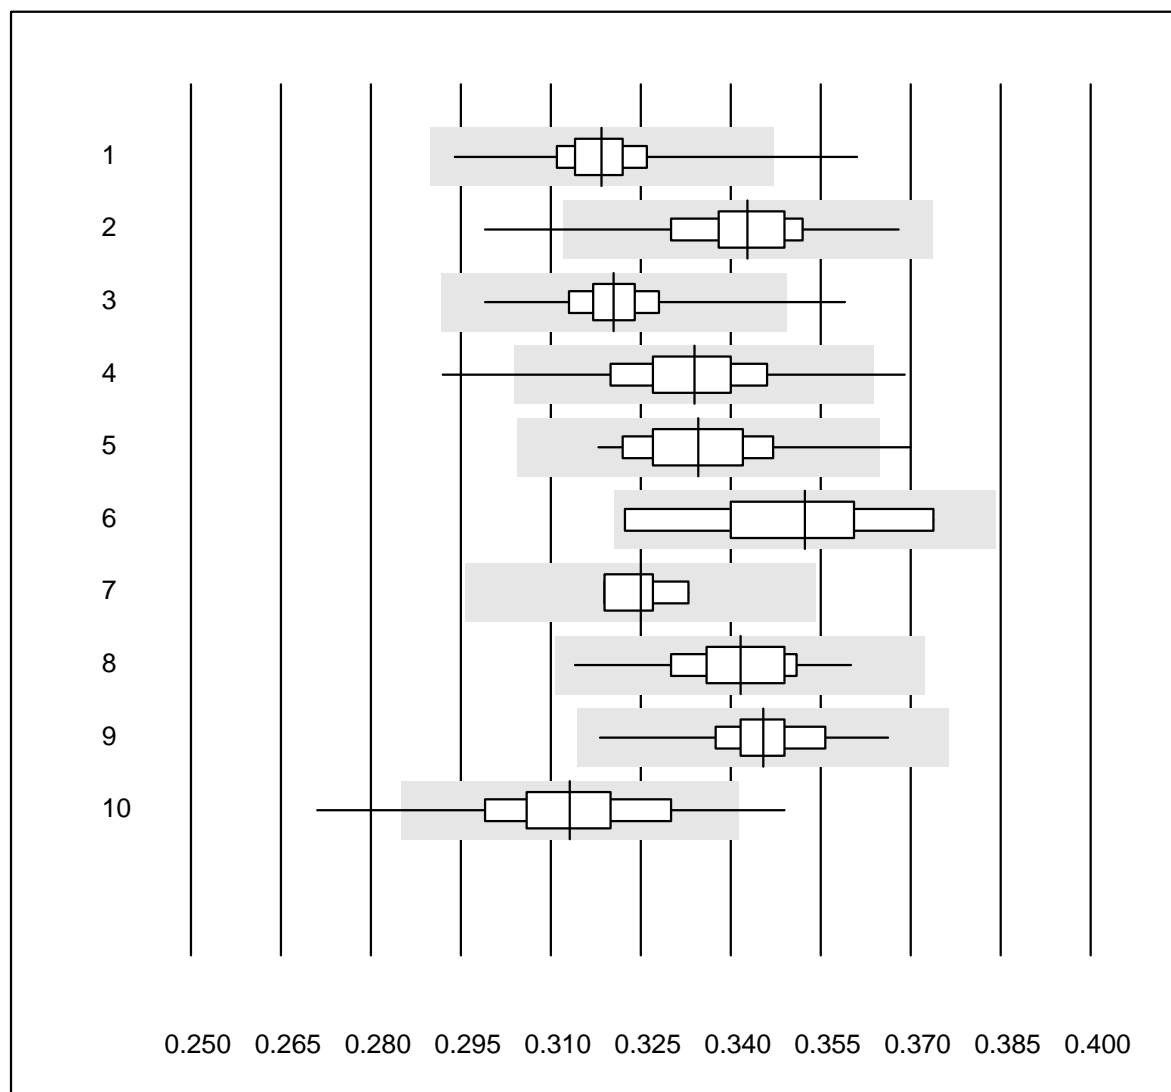


QUALAB Tolérance : 9 %

Hématocrite (l/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex KX21	206	98.5	1.0	0.5	0.32	2.4	e
2 Sysmex PochH - 100i	198	97.5	2.0	0.5	0.34	2.9	e
3 Sysmex XP 300	599	97.5	0.3	2.2	0.32	2.0	e
4 Mythic	274	94.8	2.6	2.6	0.33	3.4	e
5 Swelab	32	96.9	3.1	0.0	0.33	3.3	e
6 Abacus Junior	5	100.0	0.0	0.0	0.35	5.6	e*
7 Medonic	6	83.3	0.0	16.7	0.33	1.8	e
8 Celltac Alpha (Nihon)	85	96.5	0.0	3.5	0.34	2.7	e
9 Samsung HC10	26	100.0	0.0	0.0	0.35	2.6	e
10 Micros 60	106	94.4	2.8	2.8	0.31	4.0	e

Erythrocytes

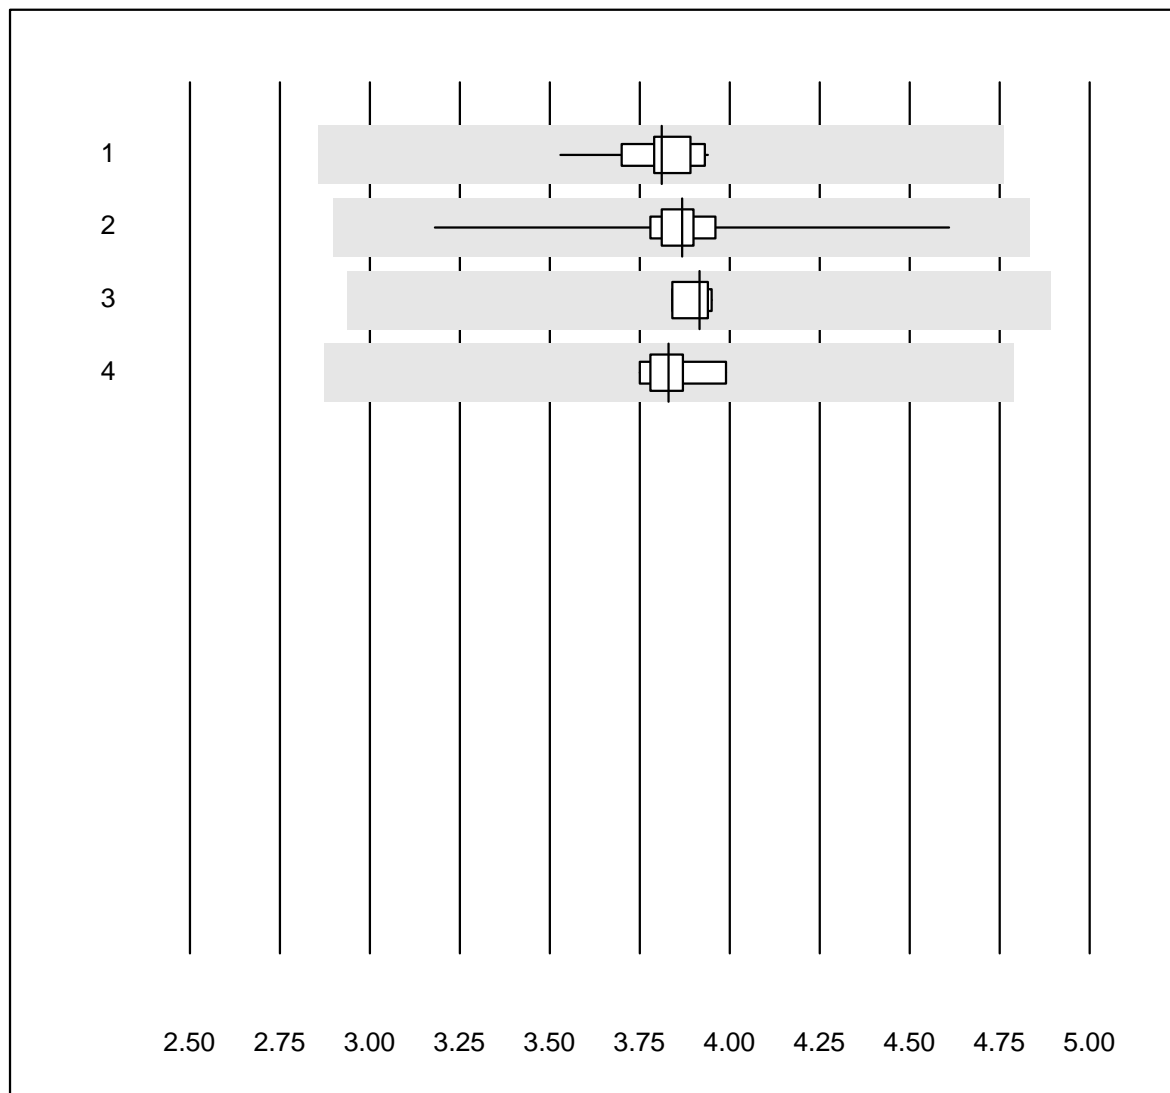


QUALAB Tolérance : 25 %

Erythrocytes (T/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Automate	14	100.0	0.0	0.0	3.81	2.9	e
2 Sysmex X	45	100.0	0.0	0.0	3.87	4.3	e
3 Advia 120	4	100.0	0.0	0.0	3.92	1.3	e
4 Sysmex	9	100.0	0.0	0.0	3.83	2.0	e

Erythrocytes

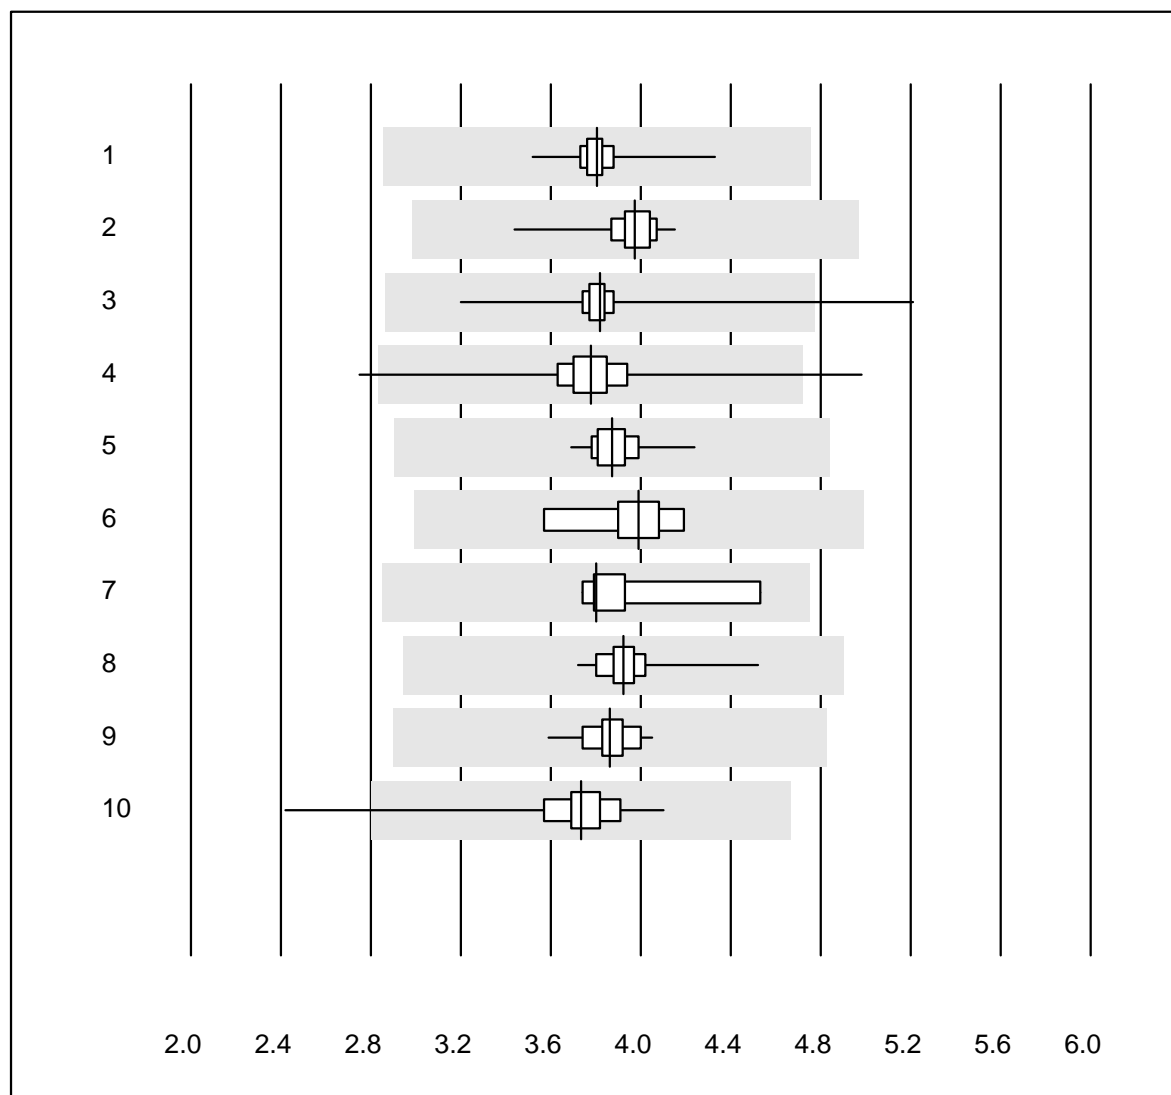


QUALAB Tolérance : 25 %

Erythrocytes (T/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	Sysmex KX21	205	100.0	0.0	0.0	3.81	2.2	e
2	Sysmex PochH - 100i	198	100.0	0.0	0.0	3.97	2.6	e
3	Sysmex XP 300	600	98.2	0.8	1.0	3.82	3.5	e
4	Mythic	274	98.6	0.7	0.7	3.78	4.7	e
5	Swelab	32	100.0	0.0	0.0	3.87	2.7	e
6	Abacus Junior	5	100.0	0.0	0.0	3.99	6.0	e
7	Medonic	6	100.0	0.0	0.0	3.80	7.6	e*
8	Celltac Alpha (Nihon	85	97.6	0.0	2.4	3.92	2.6	e
9	Samsung HC10	26	100.0	0.0	0.0	3.86	2.6	e
10	Micros 60	106	98.2	0.9	0.9	3.73	5.2	e

Leucocytes

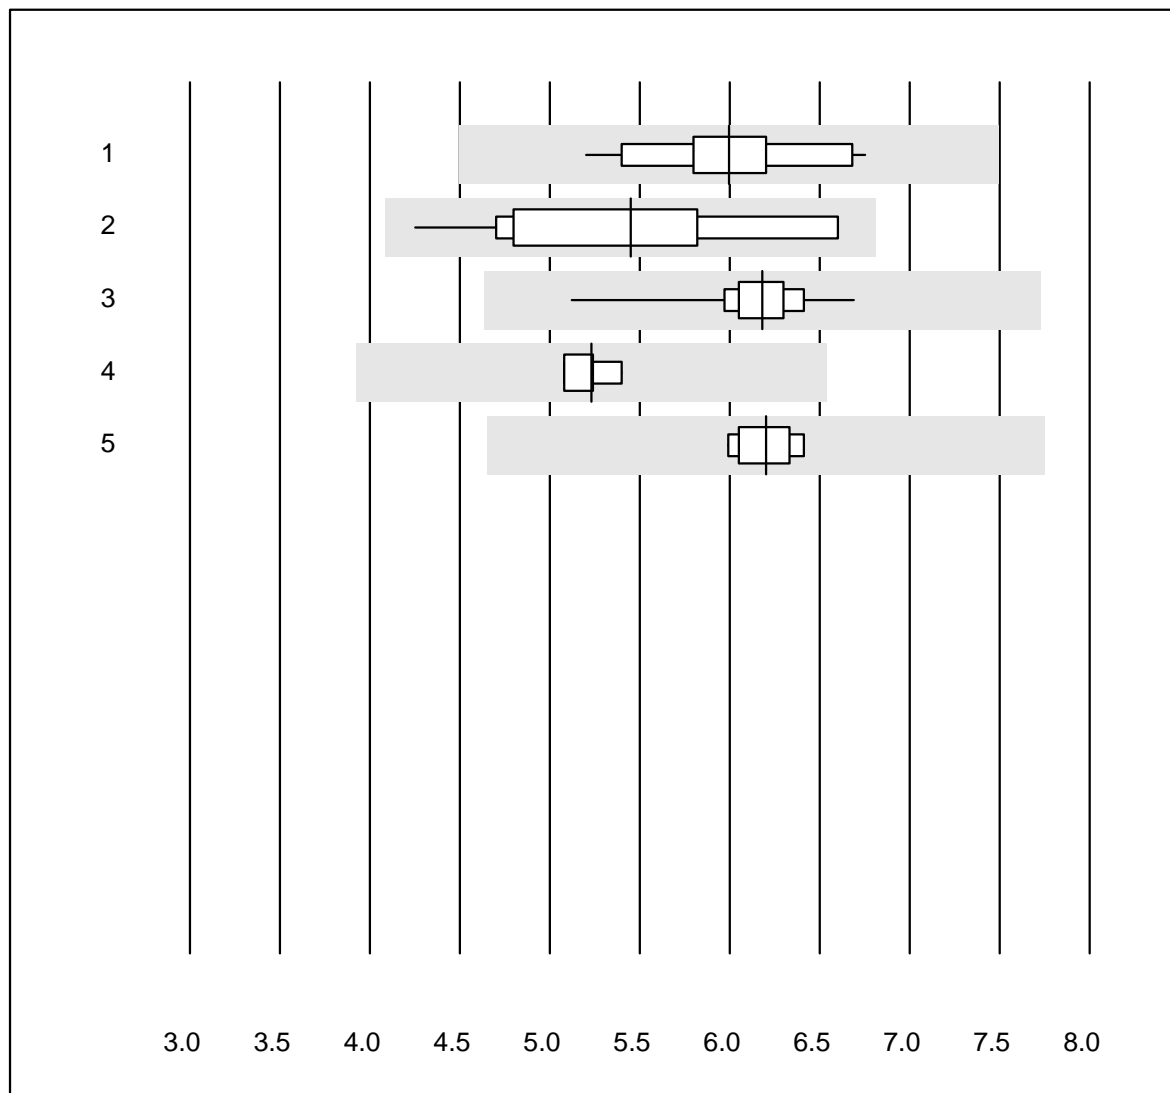


QUALAB Tolérance : 25 %

Leucocytes (G/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Automate	13	100.0	0.0	0.0	6.00	7.6	e
2 Microscopie	12	100.0	0.0	0.0	5.45	13.8	e*
3 Sysmex X	45	95.6	0.0	4.4	6.18	3.9	e
4 Advia 120 (Perox)	4	100.0	0.0	0.0	5.23	2.5	e
5 Sysmex	9	100.0	0.0	0.0	6.20	2.6	e

Leucocytes

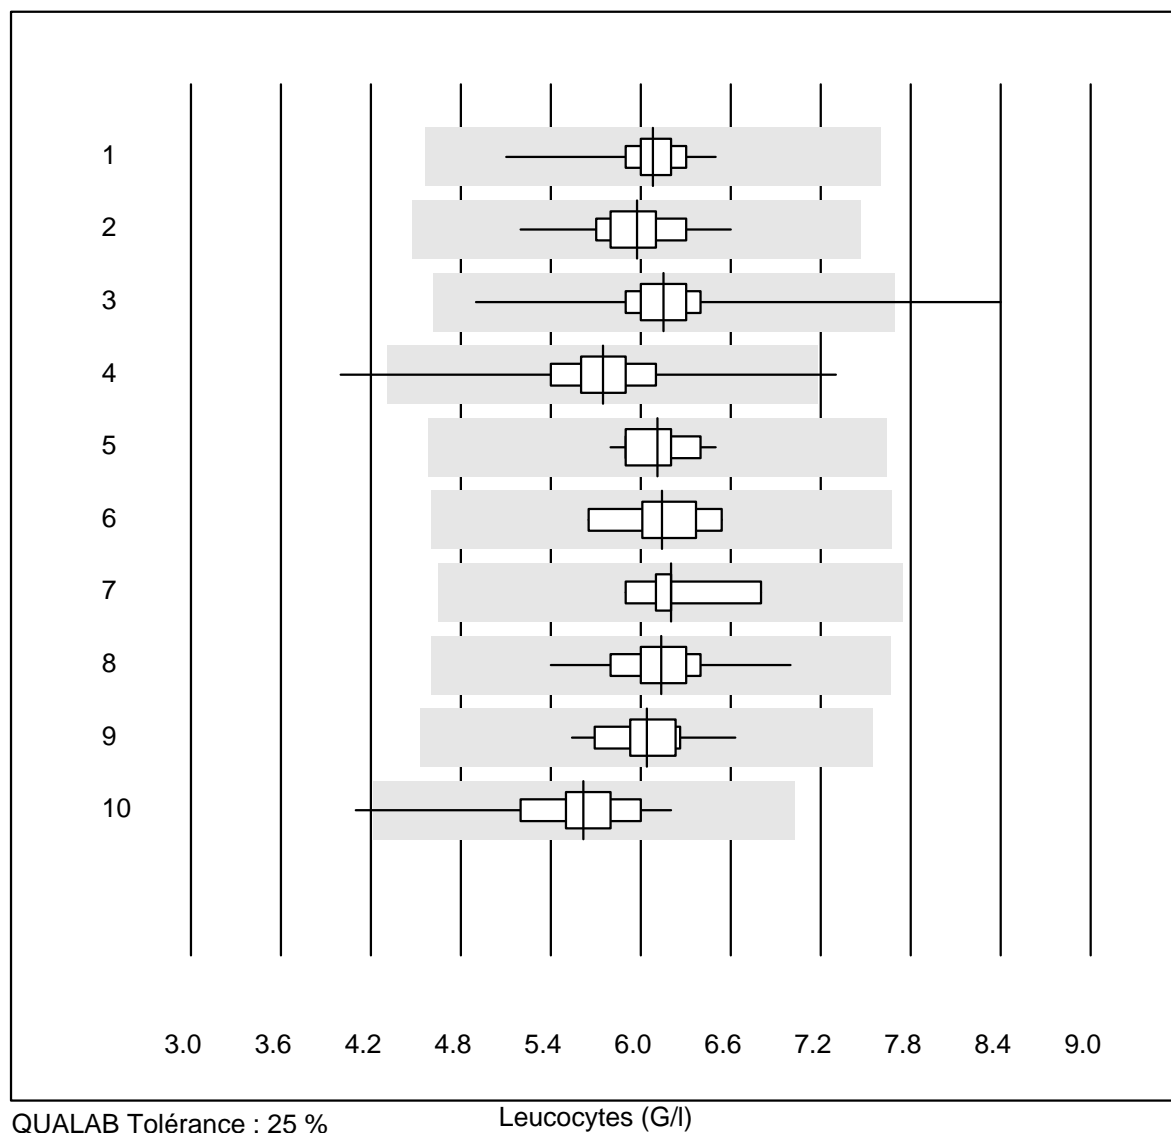

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex KX21	204	100.0	0.0	0.0	6.08	3.2	e
2 Sysmex PochH - 100i	198	100.0	0.0	0.0	5.97	3.8	e
3 Sysmex XP 300	600	99.0	0.5	0.5	6.15	4.0	e
4 Mythic	272	98.2	1.1	0.7	5.75	5.8	e
5 Swelab	32	100.0	0.0	0.0	6.11	3.1	e
6 Abacus Junior	5	100.0	0.0	0.0	6.14	5.6	e
7 Medonic	6	83.3	0.0	16.7	6.20	5.4	e
8 Celltac Alpha (Nihon)	85	98.8	0.0	1.2	6.14	4.2	e
9 Samsung HC10	26	100.0	0.0	0.0	6.04	4.2	e
10 Micros 60	106	99.1	0.9	0.0	5.62	6.5	e

Thrombocytes

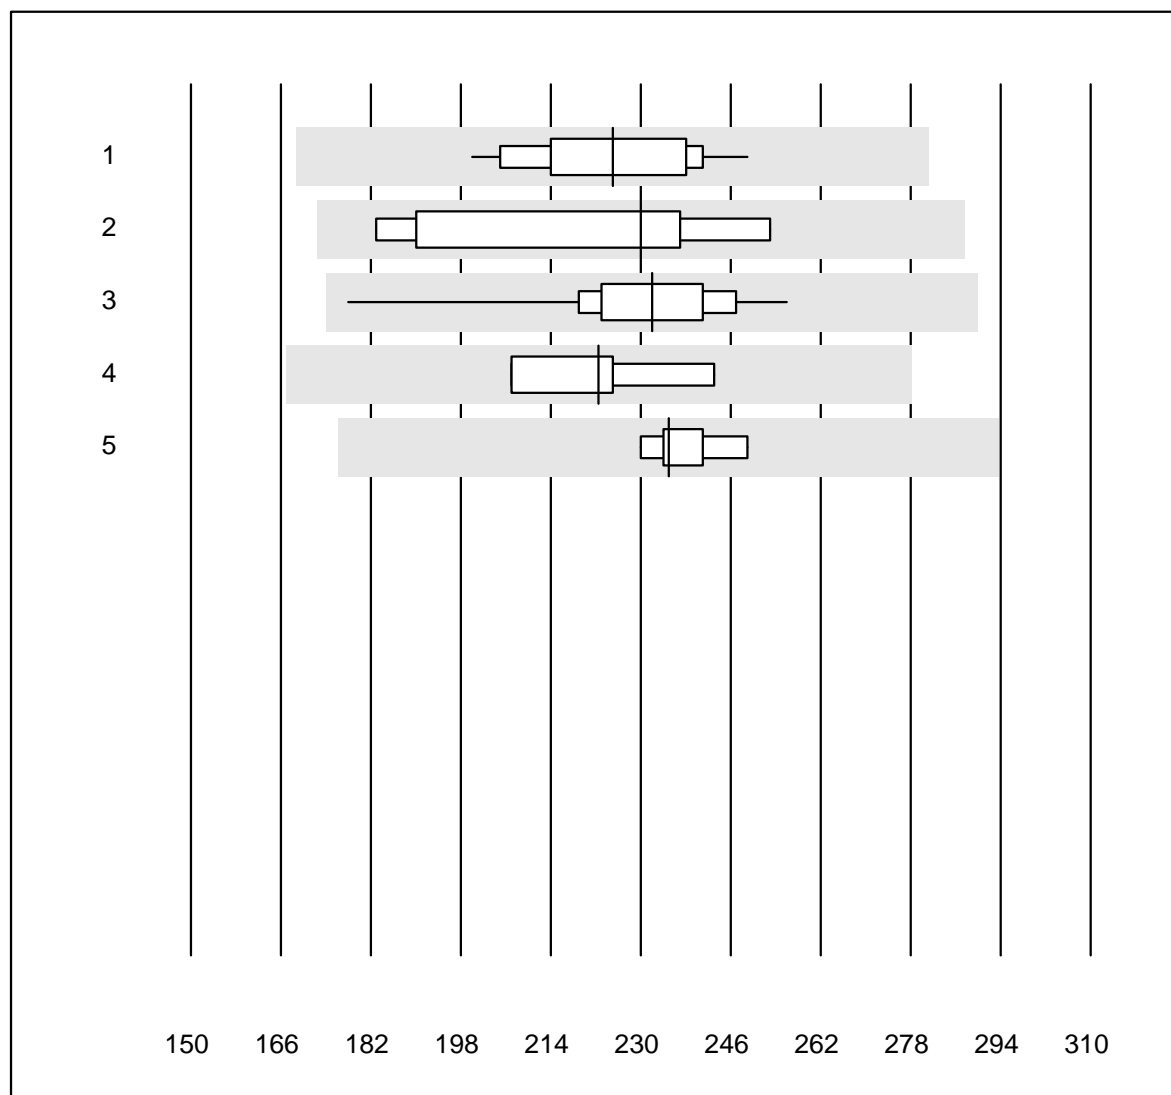


QUALAB Tolérance : 25 %

Thrombocytes (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Automate	13	100.0	0.0	0.0	225.0	7.0	e
2 Microscopie	7	100.0	0.0	0.0	230.0	11.6	e*
3 Sysmex X	45	97.8	0.0	2.2	232.0	5.8	e
4 Advia 120	4	100.0	0.0	0.0	222.5	6.7	e*
5 Sysmex	9	100.0	0.0	0.0	235.0	2.5	e

Thrombocytes

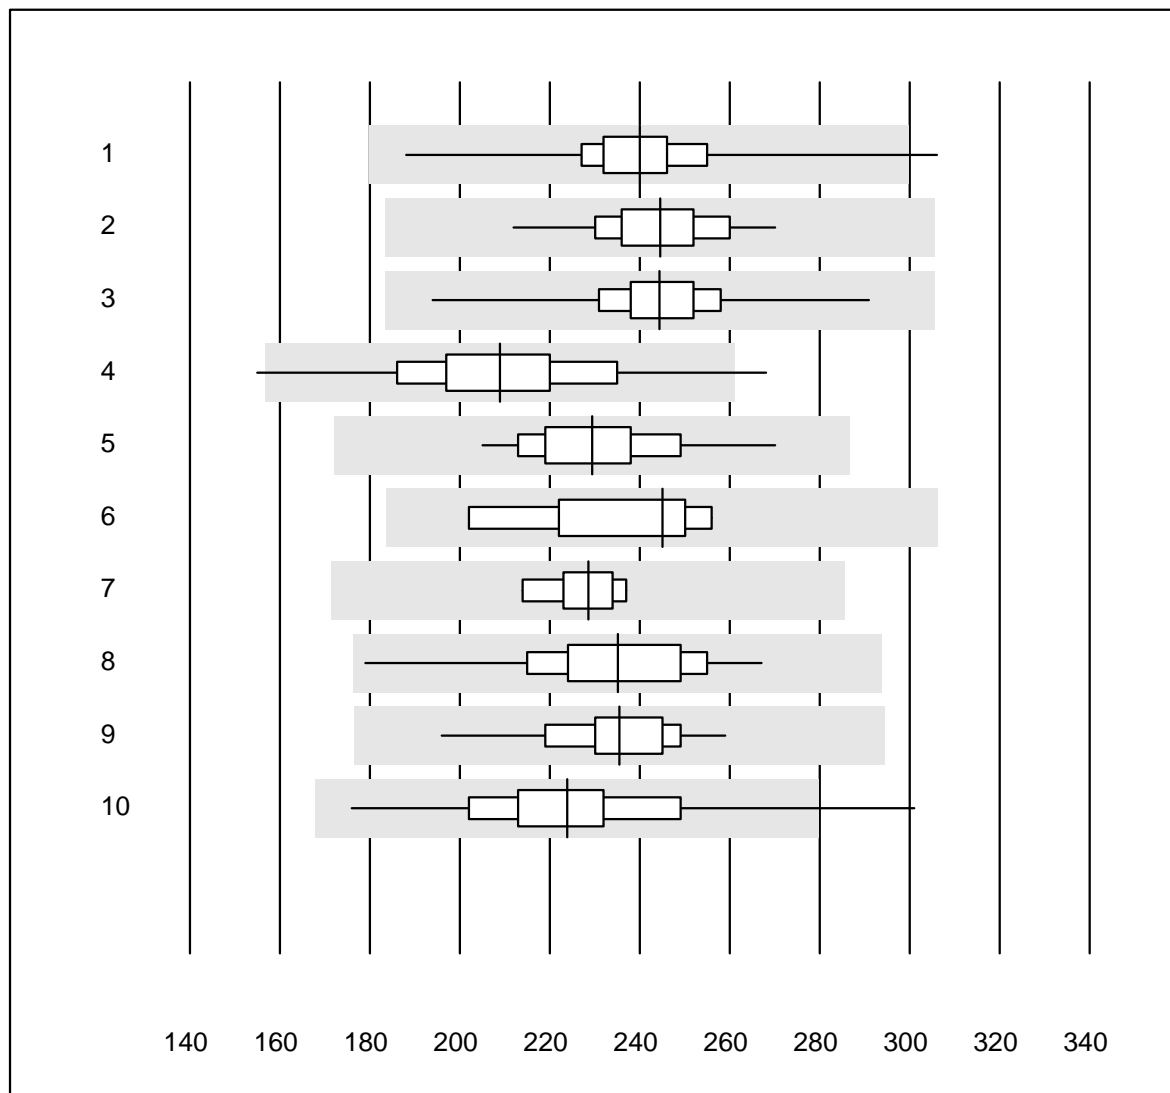


QUALAB Tolérance : 25 %

Thrombocytes (G/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	Sysmex KX21	204	99.0	0.5	0.5	239.9	5.5	e
2	Sysmex PochH - 100i	196	99.5	0.0	0.5	244.5	4.6	e
3	Sysmex XP 300	600	99.3	0.0	0.7	244.4	4.8	e
4	Mythic	274	96.3	1.5	2.2	209.0	8.9	e
5	Swelab	32	100.0	0.0	0.0	229.4	6.8	e
6	Abacus Junior	5	100.0	0.0	0.0	245.0	9.6	e*
7	Medonic	6	83.3	0.0	16.7	228.5	4.2	e
8	Celltac Alpha (Nihon	85	100.0	0.0	0.0	235.1	6.9	e
9	Samsung HC10	26	100.0	0.0	0.0	235.5	6.3	e
10	Micros 60	106	98.1	1.9	0.0	223.9	8.7	e

Hémoglobine H2

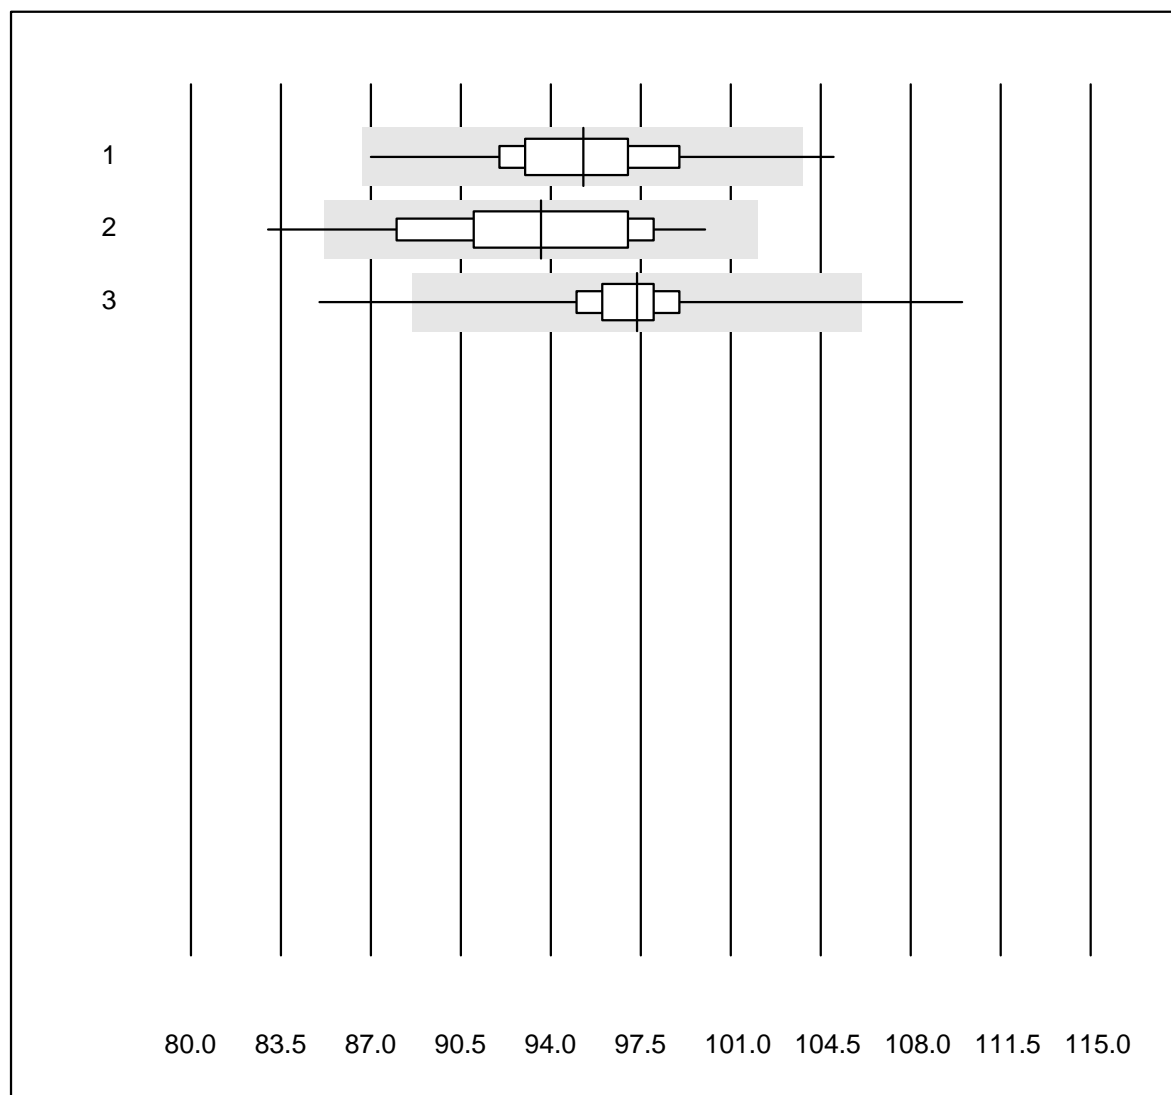


QUALAB Tolérance : 9 %

Hémoglobine H2 (g/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Z3	119	95.0	0.8	4.2	95.3	3.1	e
2 Abx Micros	87	96.6	1.1	2.3	93.6	3.9	e
3 Microsemi	822	97.0	0.6	2.4	97.3	2.0	e

Hématocrite H2

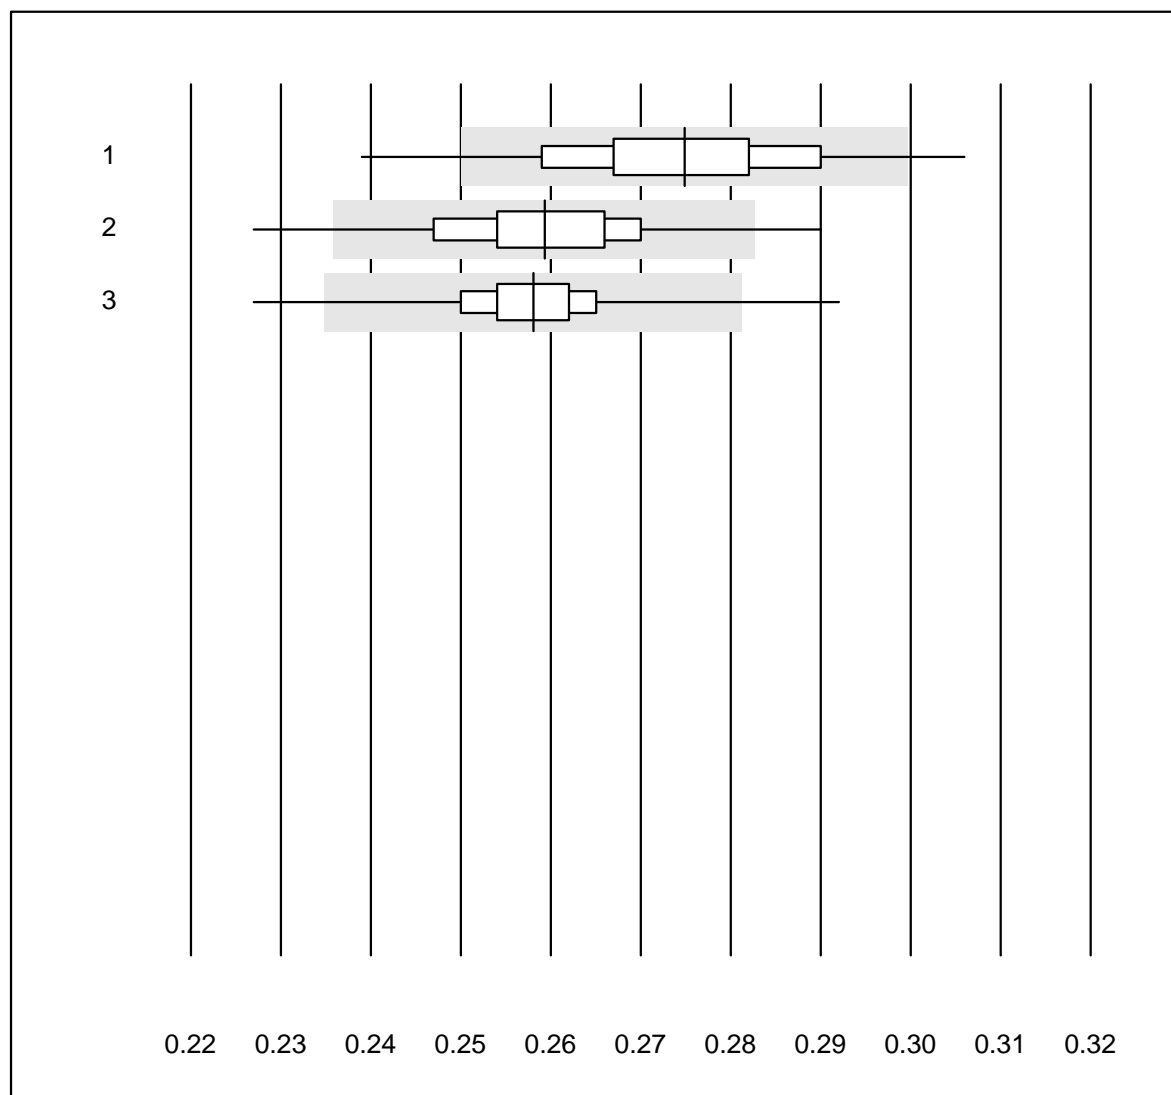


QUALAB Tolérance : 9 %

Hématocrite H2 (l/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Z3	119	89.1	5.9	5.0	0.27	4.6	e
2 Abx Micros	87	90.8	4.6	4.6	0.26	4.0	e
3 Microsemi	823	95.8	1.5	2.7	0.26	2.7	e

Leucocytes H2

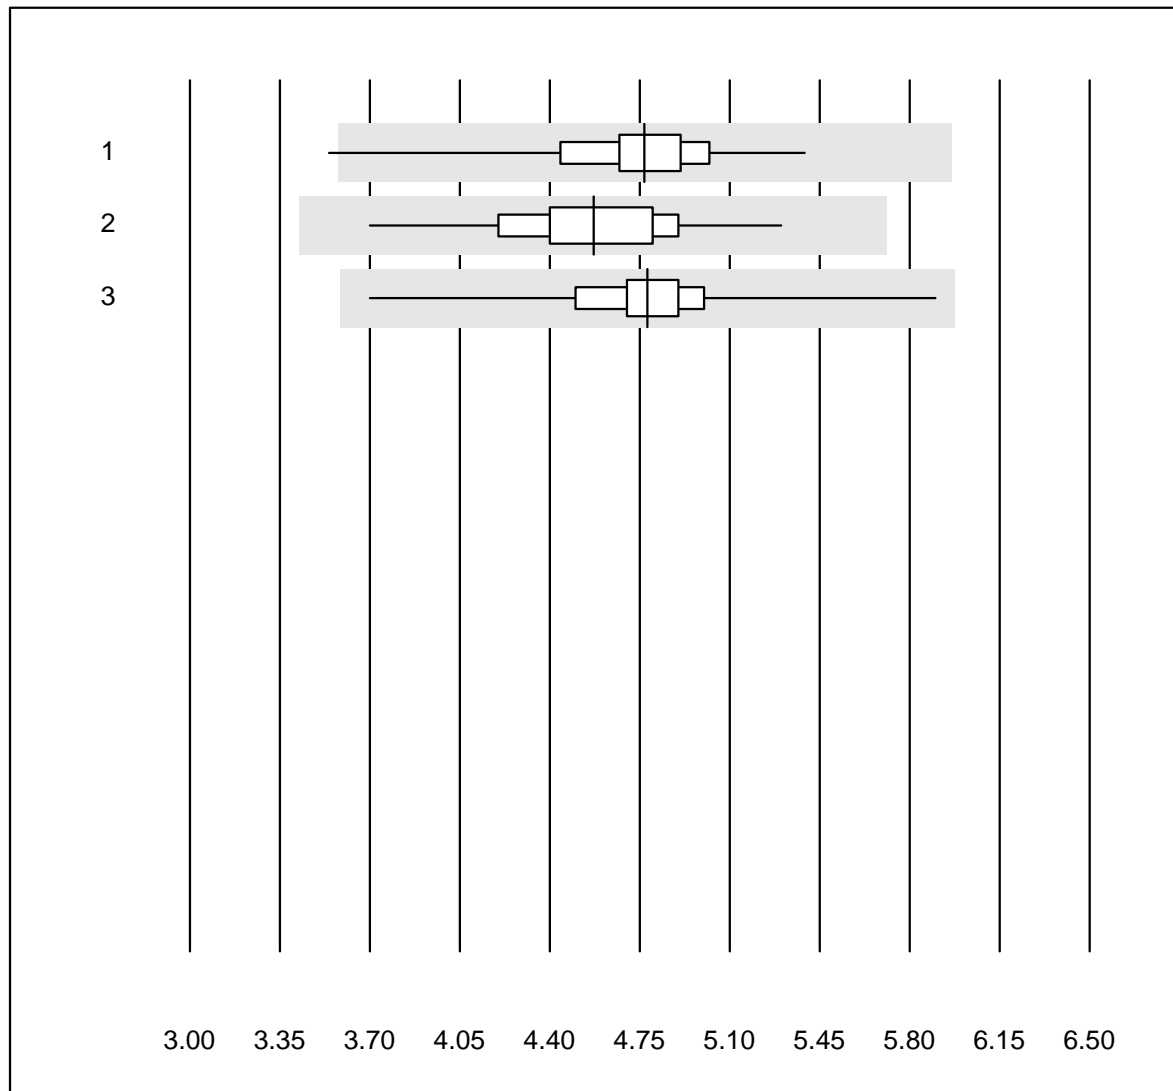


QUALAB Tolérance : 25 %

Leucocytes H2 (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Z3	119	98.4	0.8	0.8	4.77	5.3	e
2 Abx Micros	87	100.0	0.0	0.0	4.57	6.1	e
3 Microsemi	823	99.5	0.0	0.5	4.78	4.3	e

Thrombocytes H2

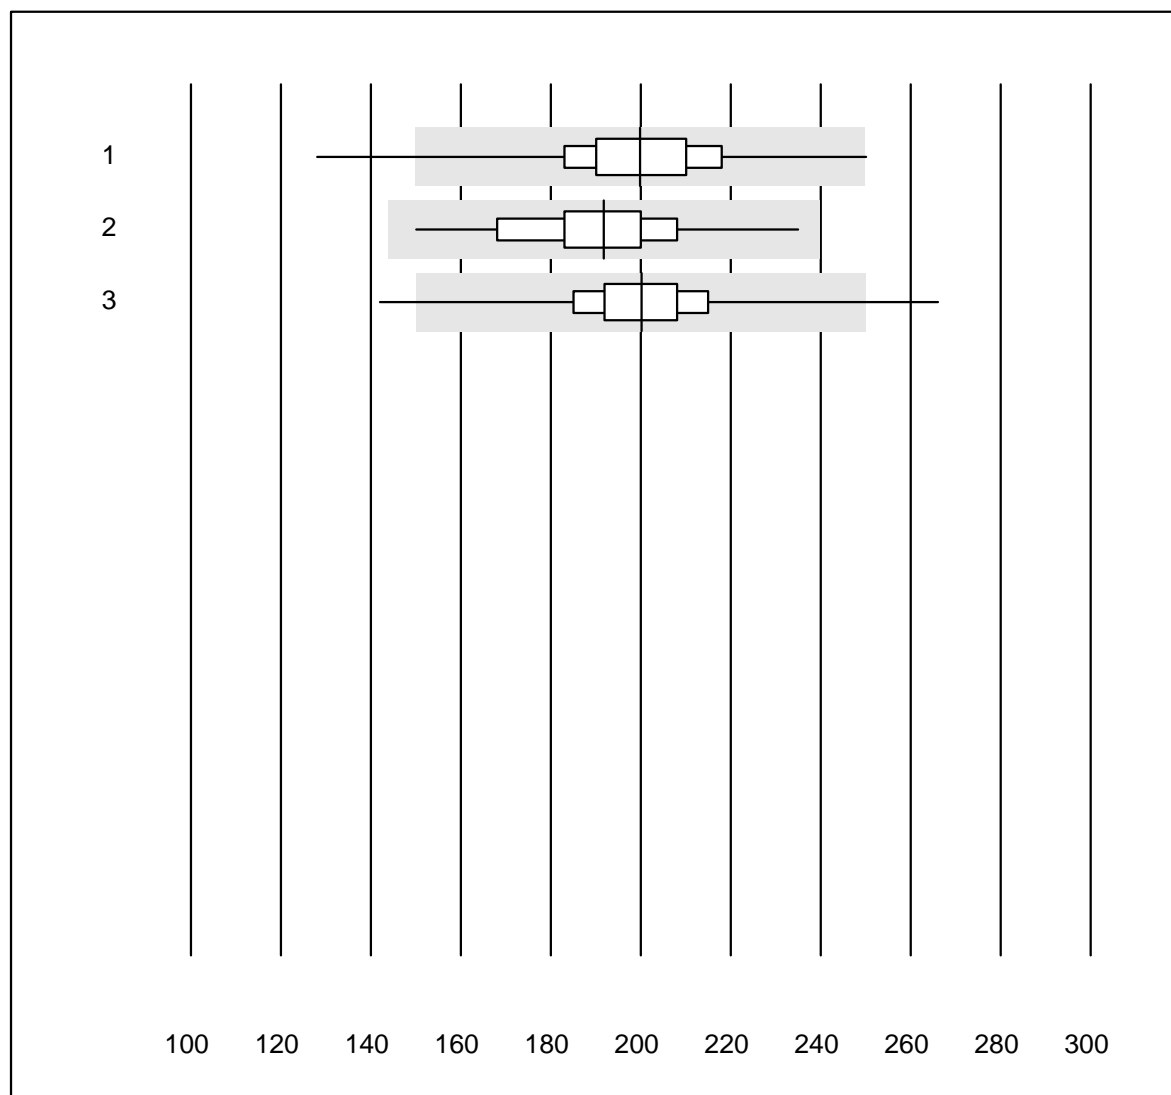


QUALAB Tolérance : 25 %

Thrombocytes H2 (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Z3	119	97.5	1.7	0.8	199.9	7.5	e
2 Abx Micros	87	96.6	0.0	3.4	191.8	8.6	e
3 Microsemi	823	97.1	1.1	1.8	200.1	6.8	e

Erythrocytes H2

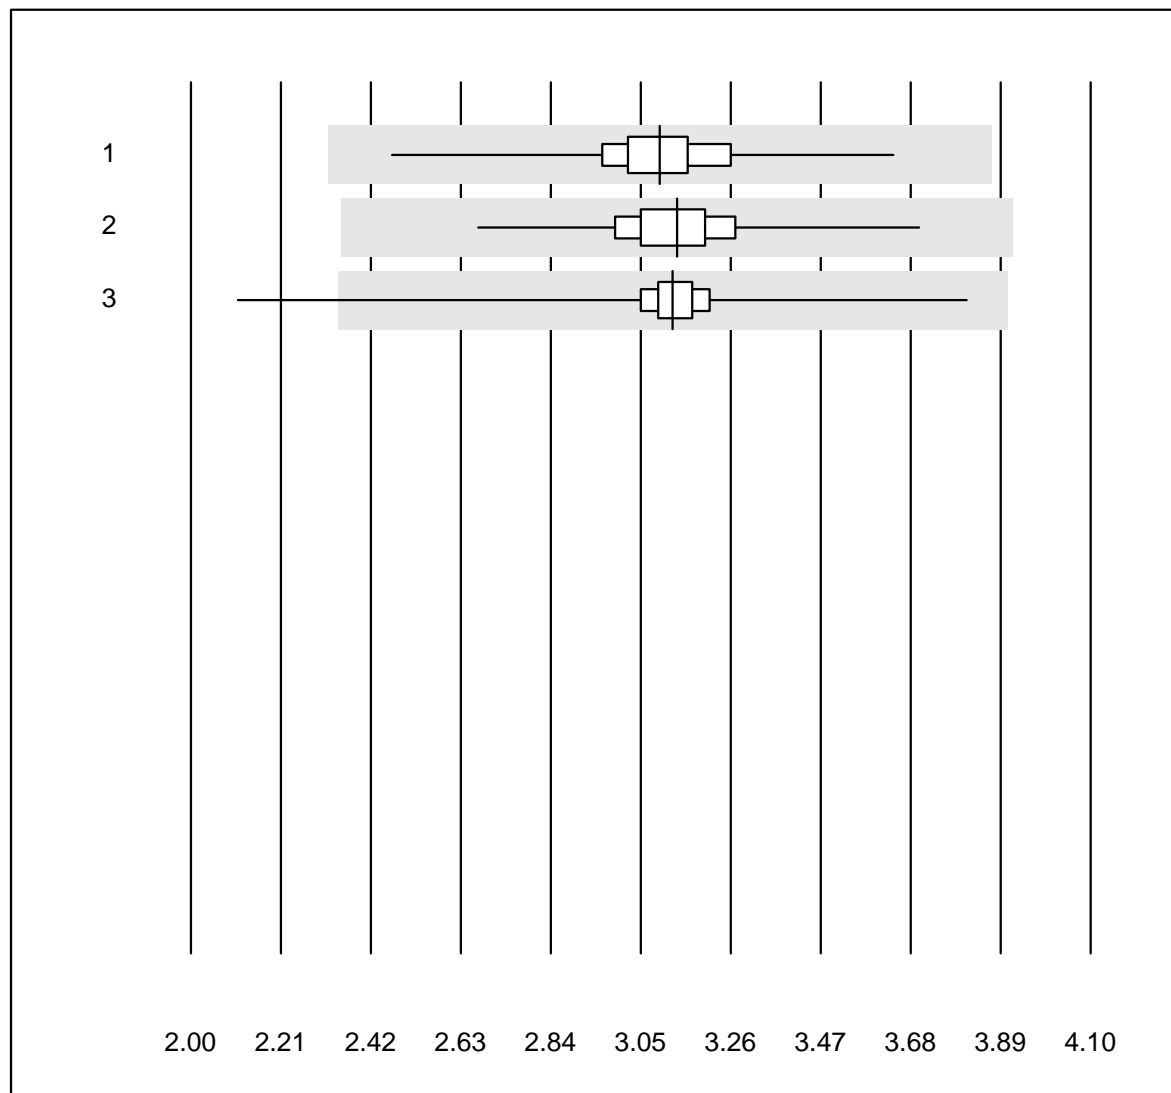


QUALAB Tolérance : 25 %

Erythrocytes H2 (T/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Z3	119	97.5	0.0	2.5	3.09	4.7	e
2 Abx Micros	87	95.4	0.0	4.6	3.13	4.7	e
3 Microsemi	825	98.5	0.5	1.0	3.12	4.1	e

CRP H2

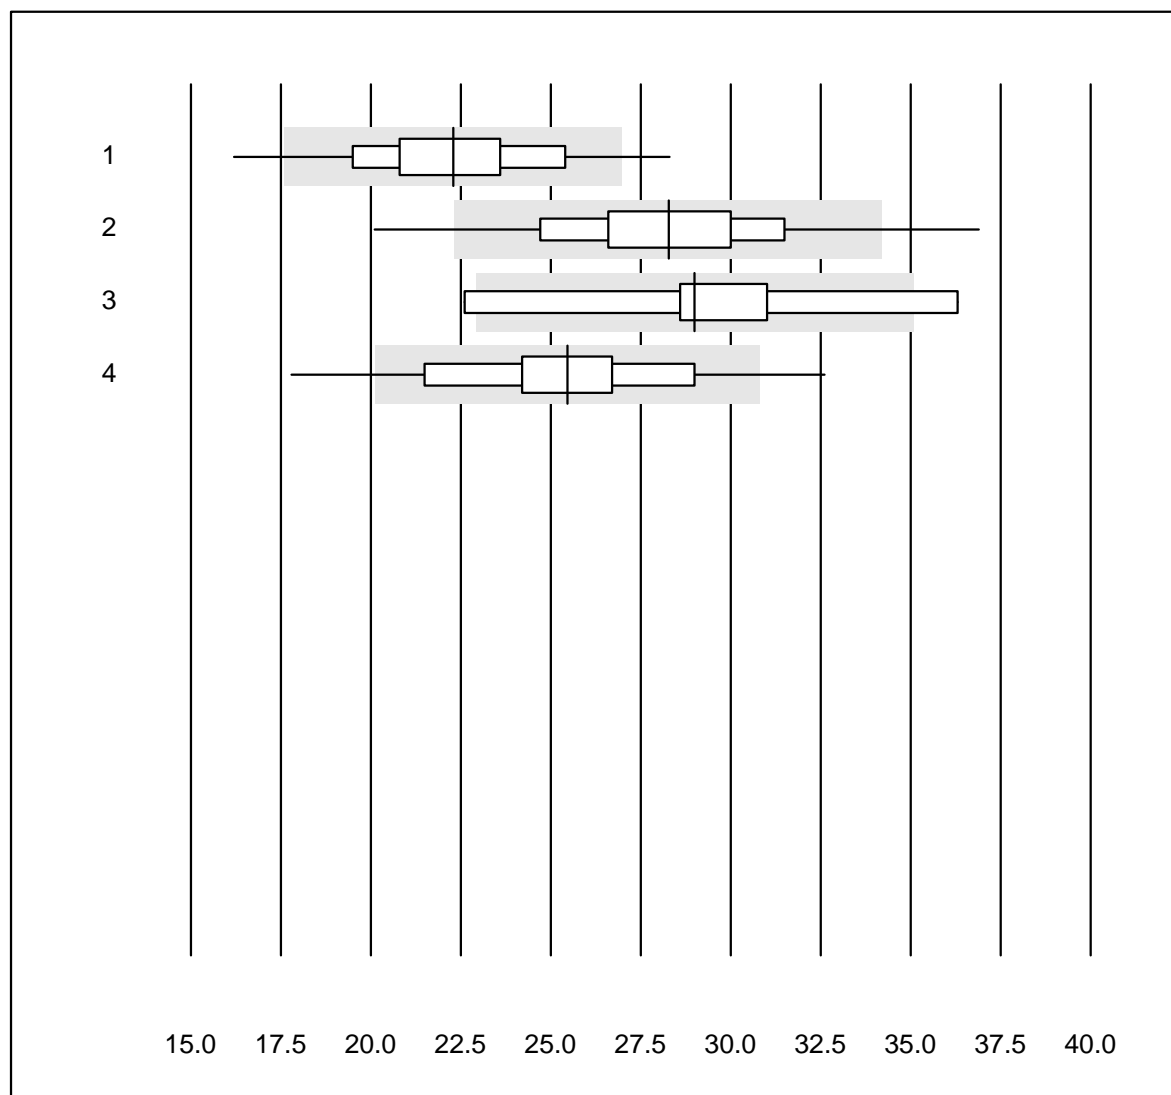


QUALAB Tolérance : 21 %

CRP H2 (mg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Z3	107	92.5	4.7	2.8	22.3	9.9	e
2 Microsemi	815	95.5	2.5	2.0	28.3	9.4	e
3 Abx Micros	8	62.5	25.0	12.5	29.0	13.7	e*
4 ABX Micros CRP200	80	91.2	6.3	2.5	25.5	10.8	e

Hémoglobine BG

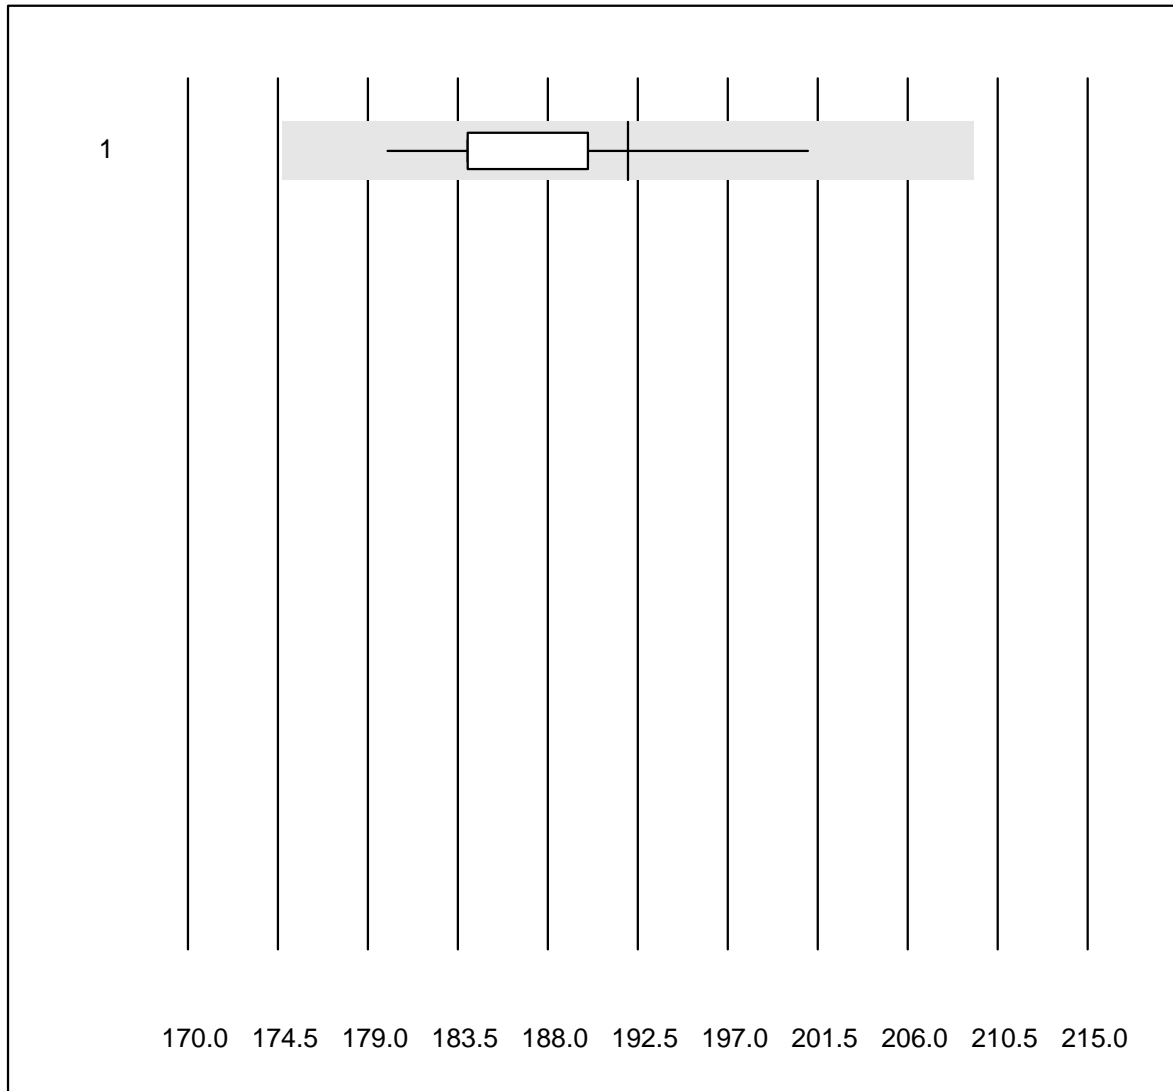


QUALAB Tolérance : 9 %

Hémoglobine BG (g/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 iStat	12	100.0	0.0	0.0	192.0	2.7	a

Hématocrite

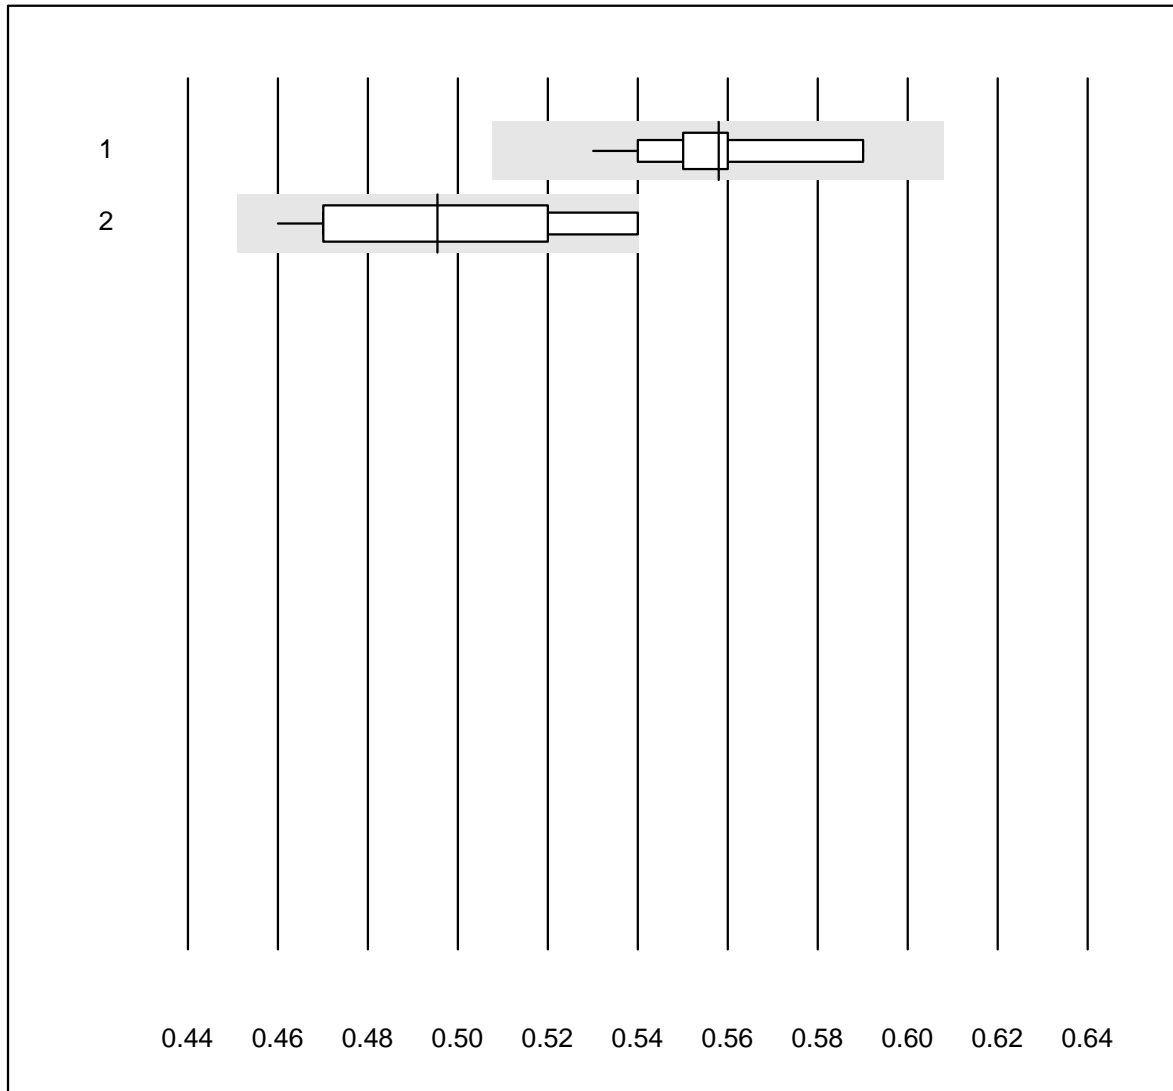


QUALAB Tolérance : 9 %

Hématocrite (l/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 iStat	19	100.0	0.0	0.0	0.56	2.8	e
2 EPOC	12	91.7	0.0	8.3	0.50	6.2	e*

Hémoglobine

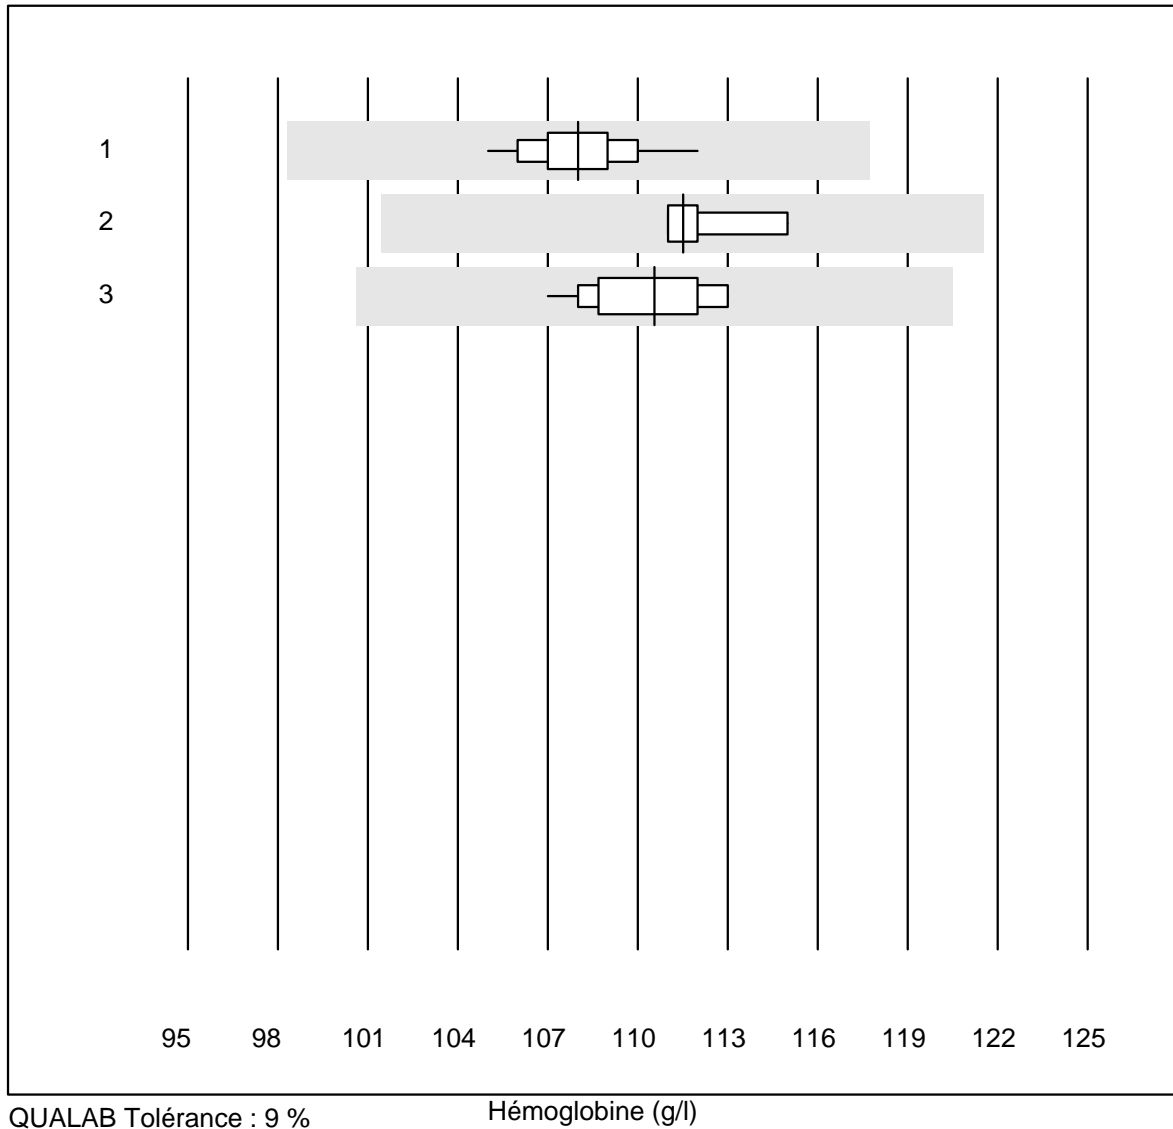

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	78	100.0	0.0	0.0	108.0	1.5	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	111.5	1.7	e
3 Yumizen/Pentra	17	94.1	0.0	5.9	110.5	1.7	e

Hématocrite

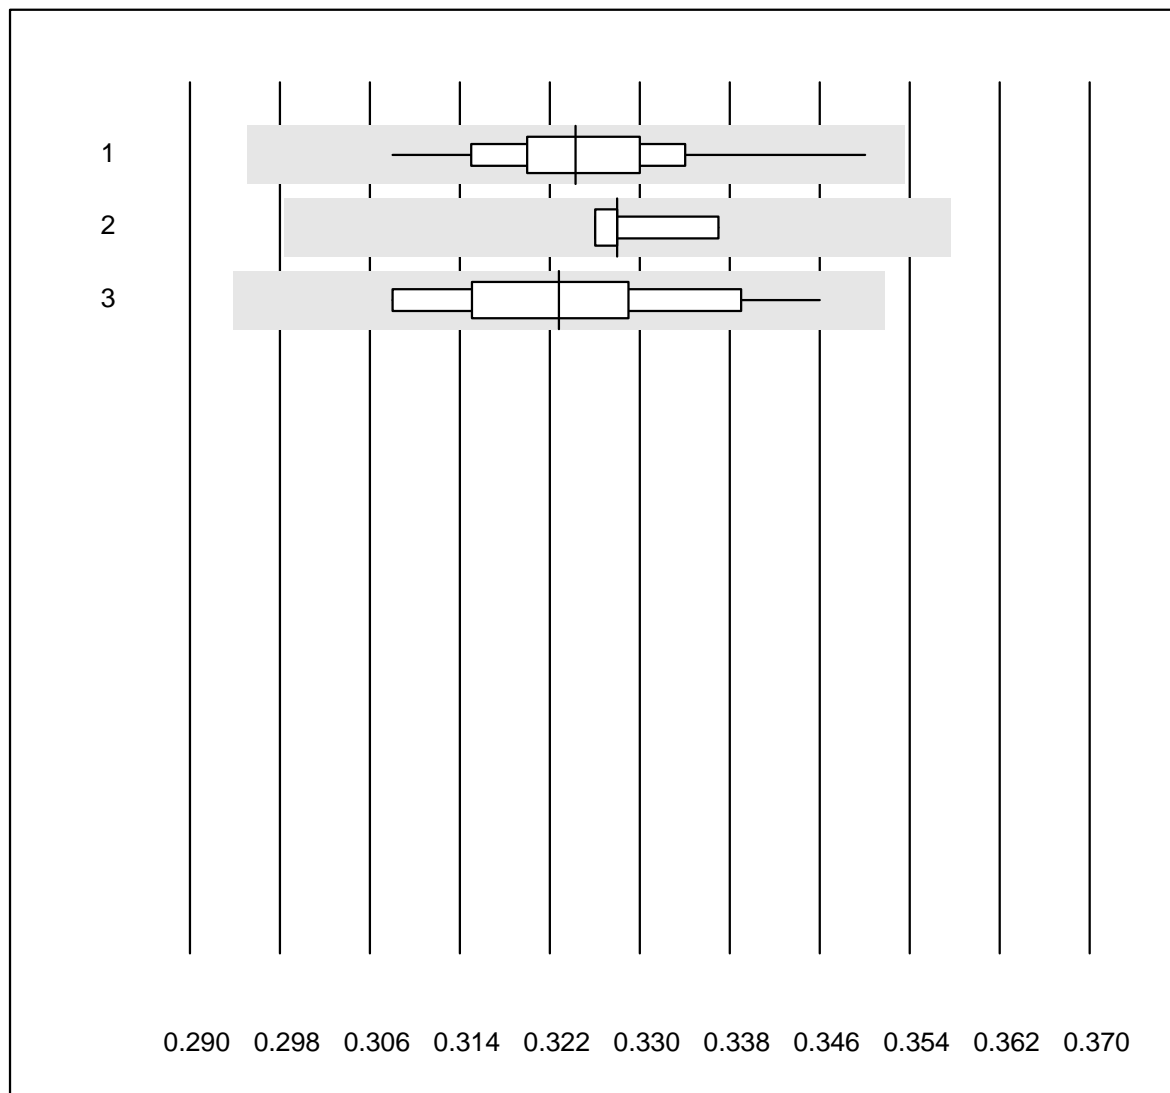


QUALAB Tolérance : 9 %

Hématocrite (l/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	80	98.7	0.0	1.3	0.32	2.5	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	0.33	1.5	e
3 Yumizen/Pentra	17	94.1	0.0	5.9	0.32	3.3	e

Erythrocytes

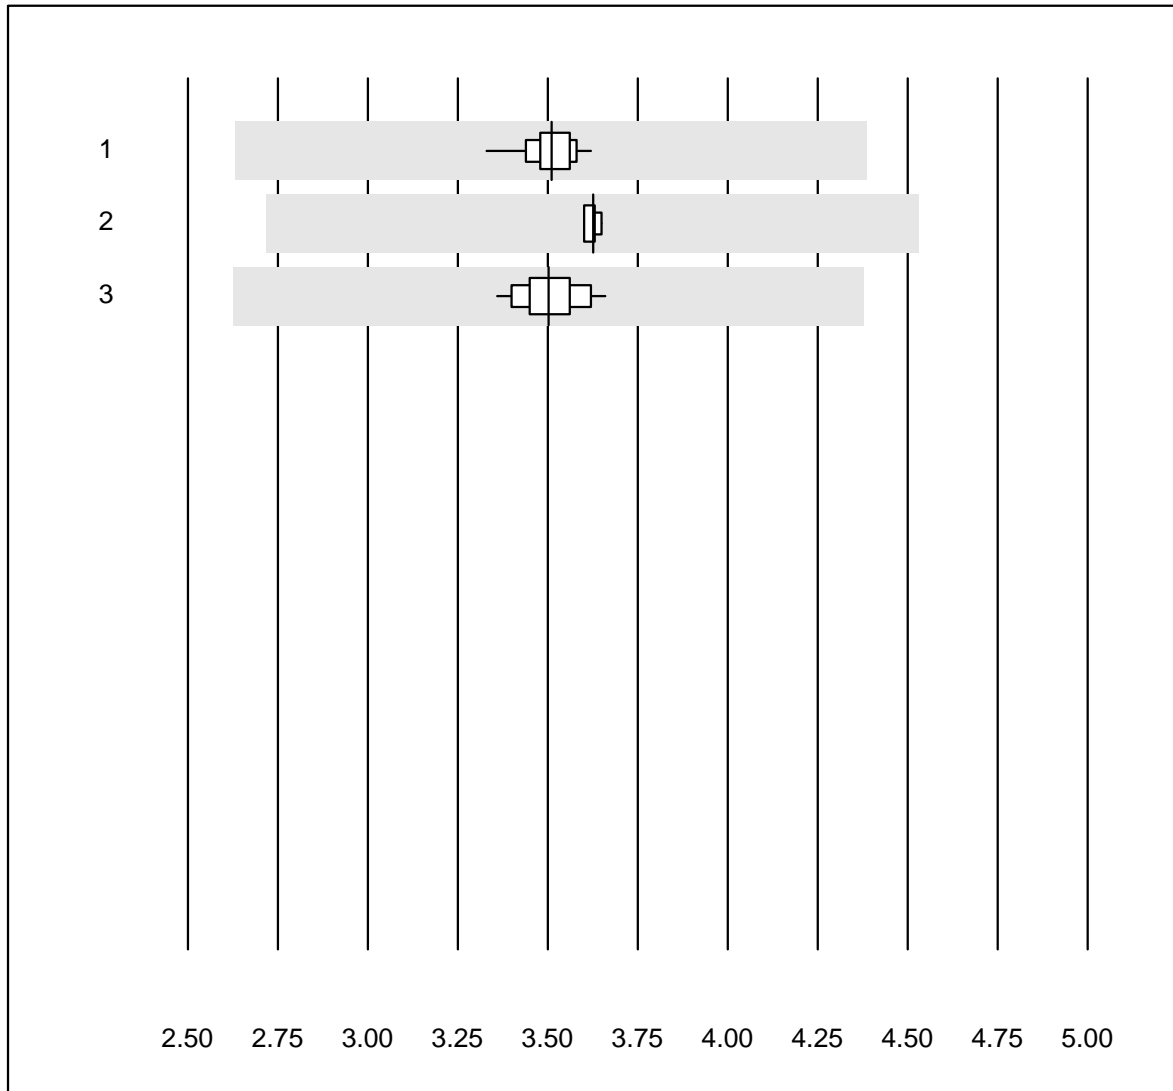


QUALAB Tolérance : 25 %

Erythrocytes (T/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	80	100.0	0.0	0.0	3.51	1.6	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	3.63	0.6	e
3 Yumizen/Pentra	17	94.1	0.0	5.9	3.50	2.3	e

Leucocytes

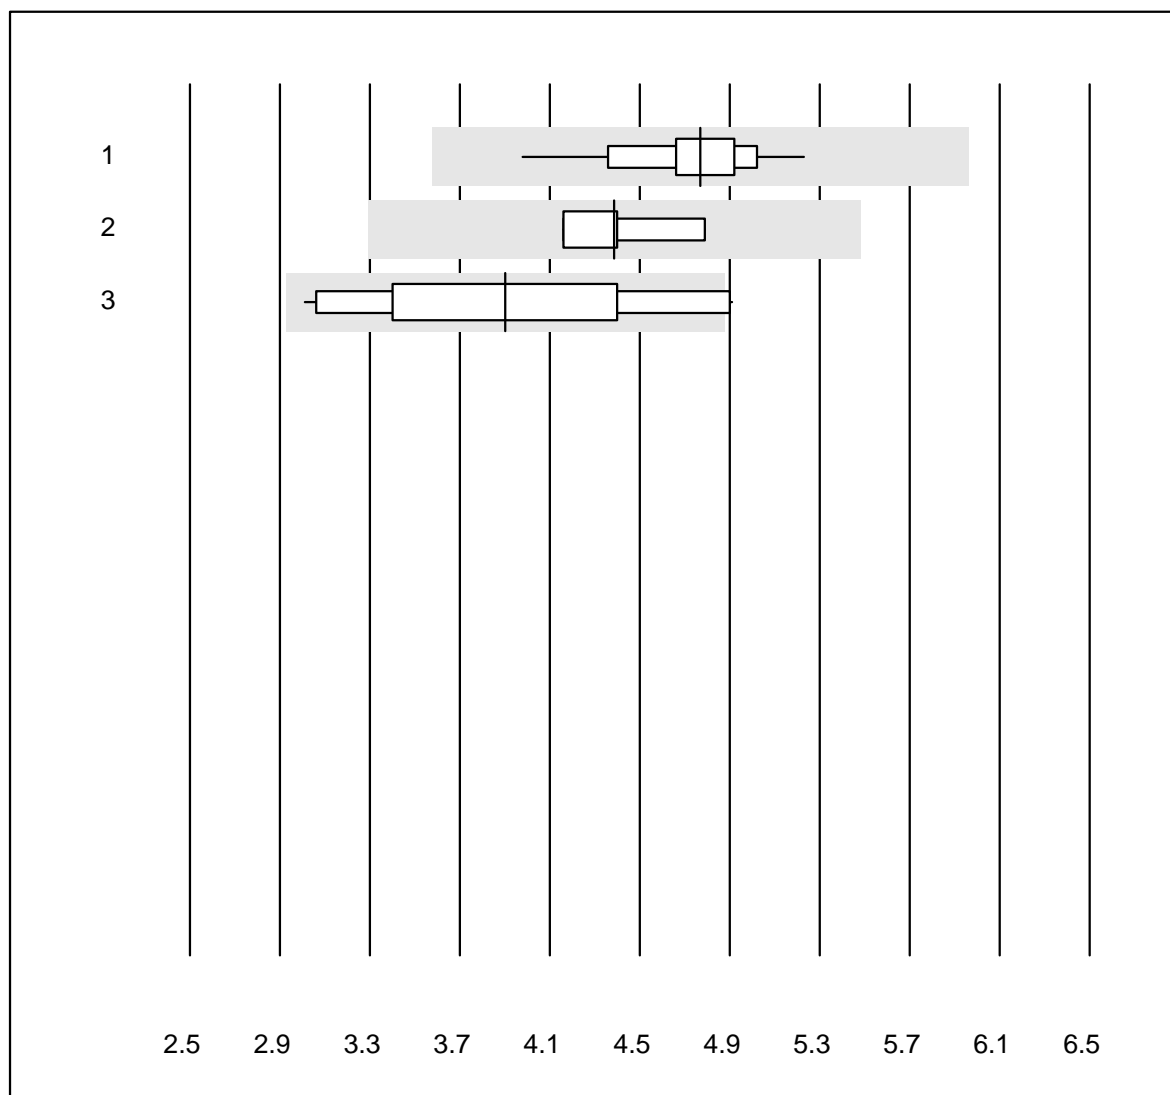


QUALAB Tolérance : 25 %

Leucocytes (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	79	100.0	0.0	0.0	4.77	5.0	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	4.39	5.9	e
3 Yumizen/Pentra	17	82.3	11.8	5.9	3.90	16.9	e*

Thrombocytes

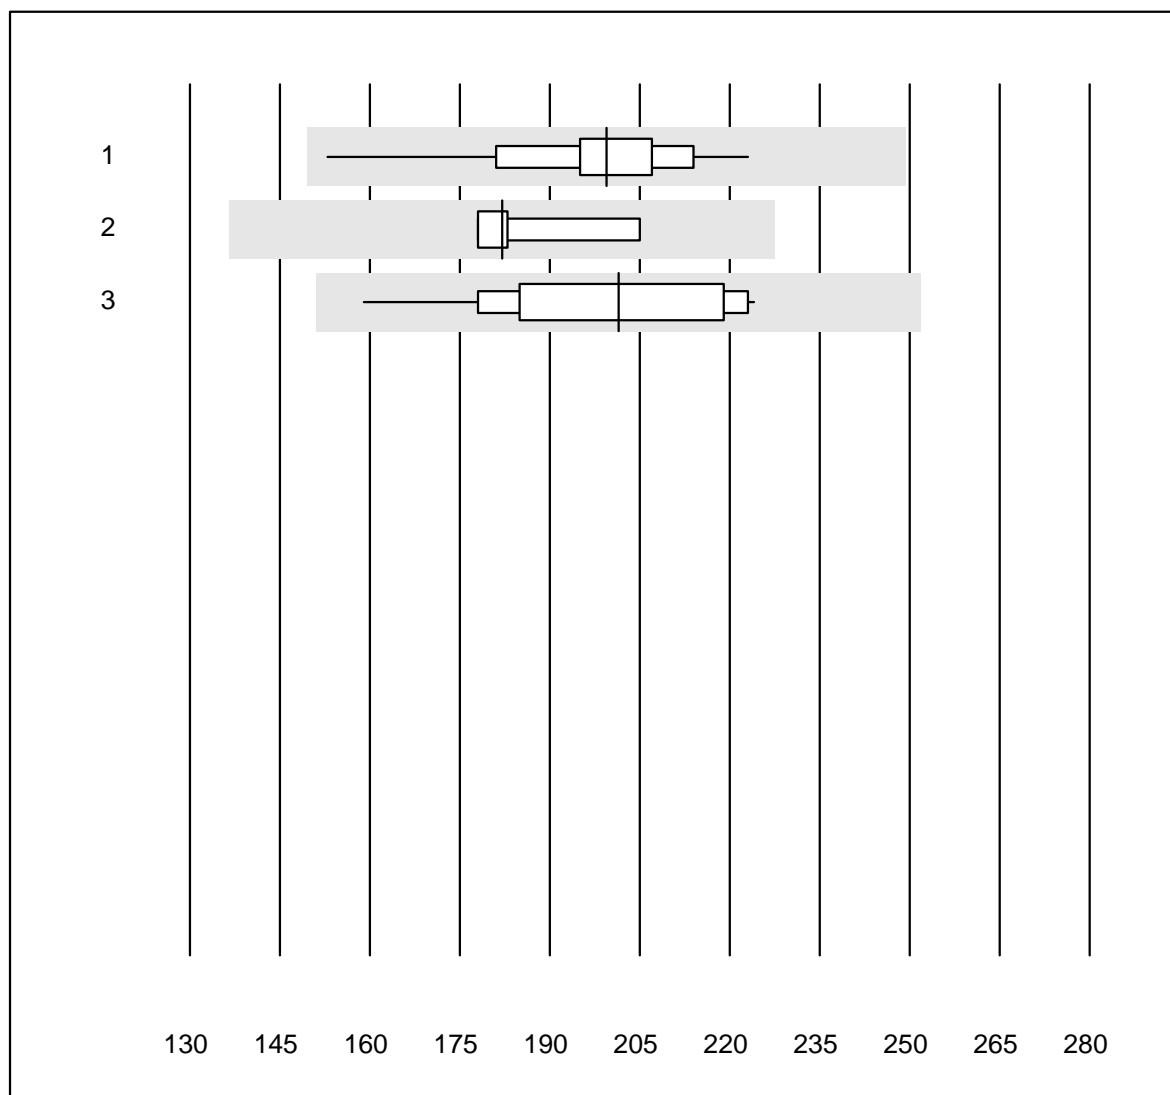


QUALAB Tolérance : 25 %

Thrombocytes (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	78	100.0	0.0	0.0	199.4	6.5	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	182.0	6.6	e*
3 Yumizen/Pentra	17	100.0	0.0	0.0	201.5	9.3	e

Neutrophiles

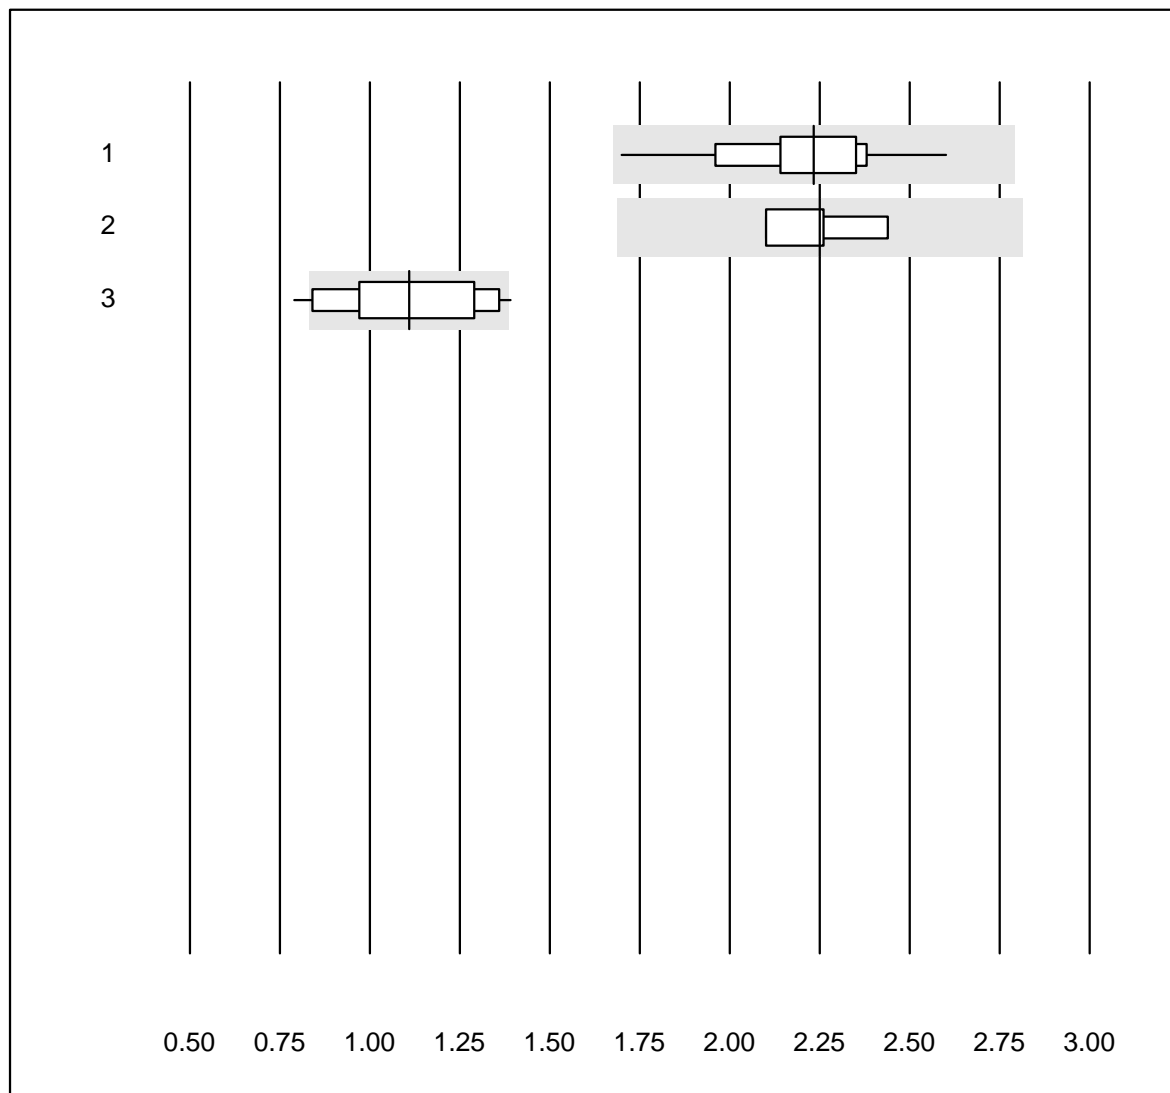


Tolérance MQ : 25 %

Neutrophiles (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	80	100.0	0.0	0.0	2.23	7.8	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	2.25	6.2	e*
3 Yumizen/Pentra	16	62.5	12.5	25.0	1.11	17.6	e*

Lymphocytes

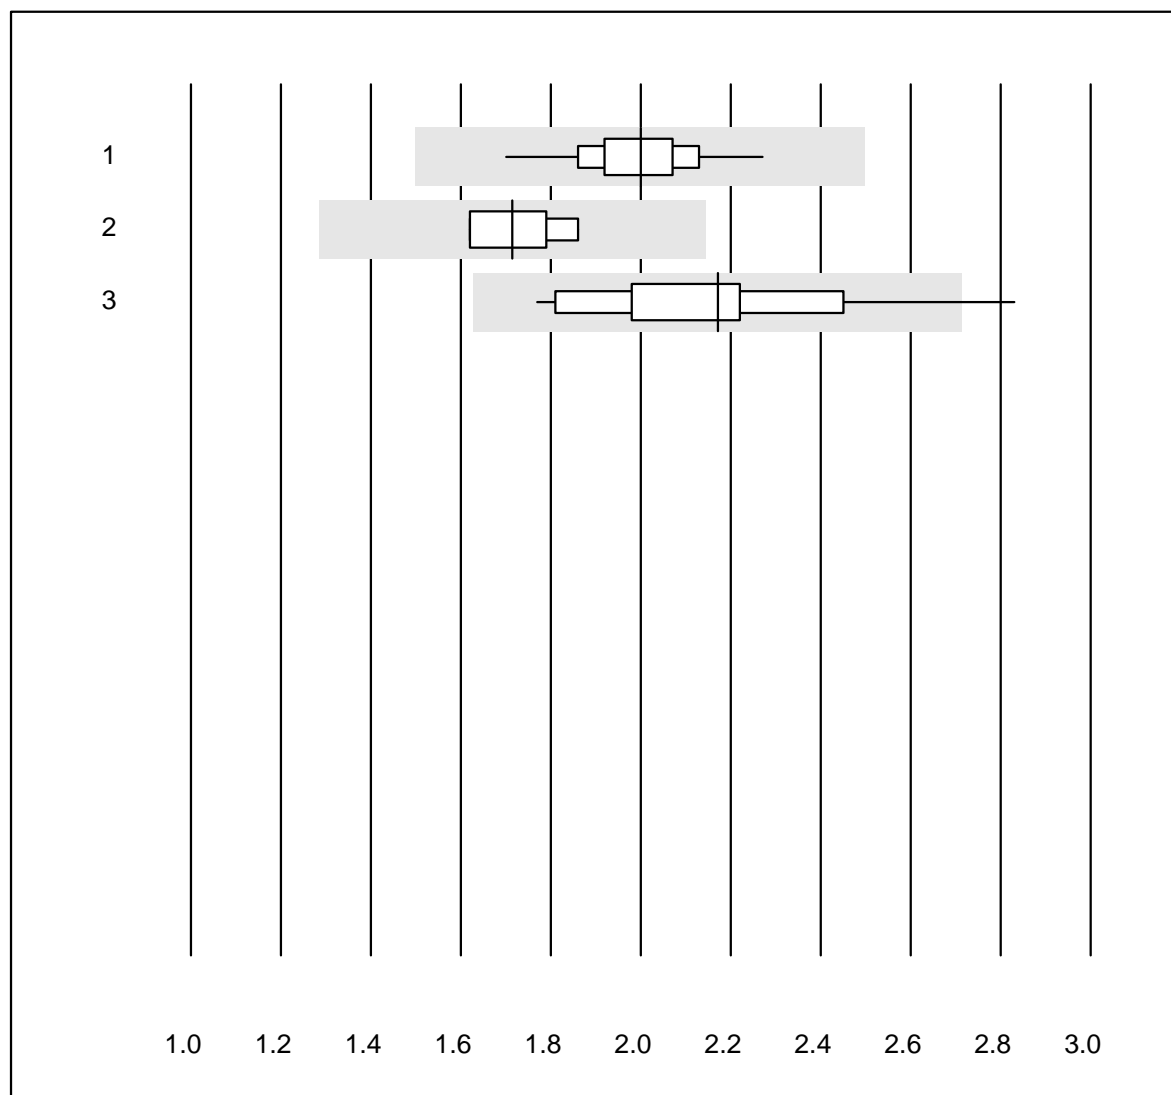


Tolérance MQ : 25 %

Lymphocytes (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	80	98.7	0.0	1.3	2.00	5.5	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	1.72	6.7	e*
3 Yumizen/Pentra	16	87.4	6.3	6.3	2.17	12.2	e*

Monocytes

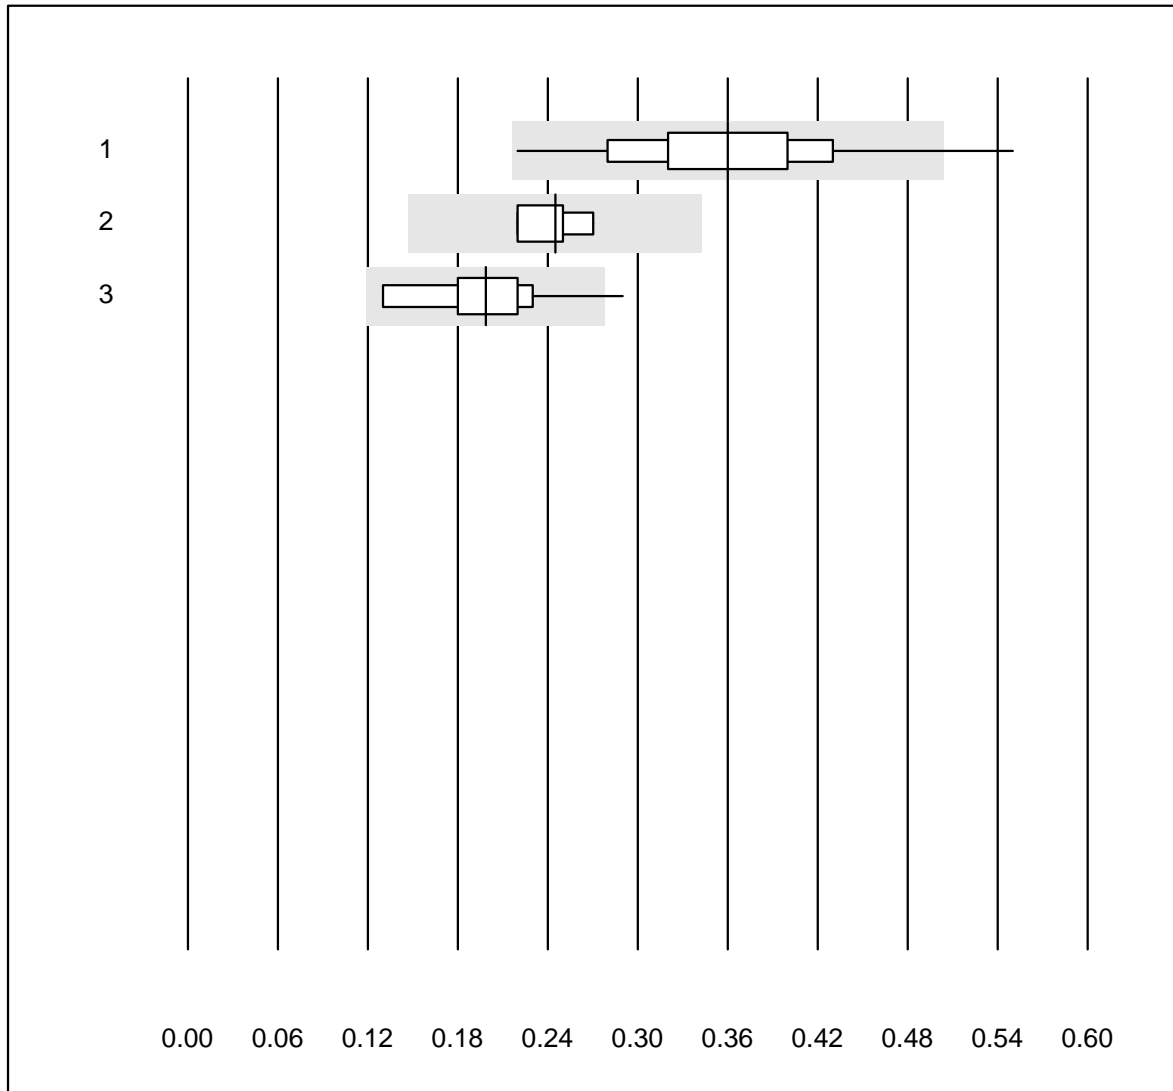


Tolérance MQ : 40 %

Monocytes (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	80	97.4	1.3	1.3	0.36	17.1	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	0.25	8.5	e
3 Yumizen/Pentra	16	74.9	6.3	18.8	0.20	22.0	e*

Eosinophiles

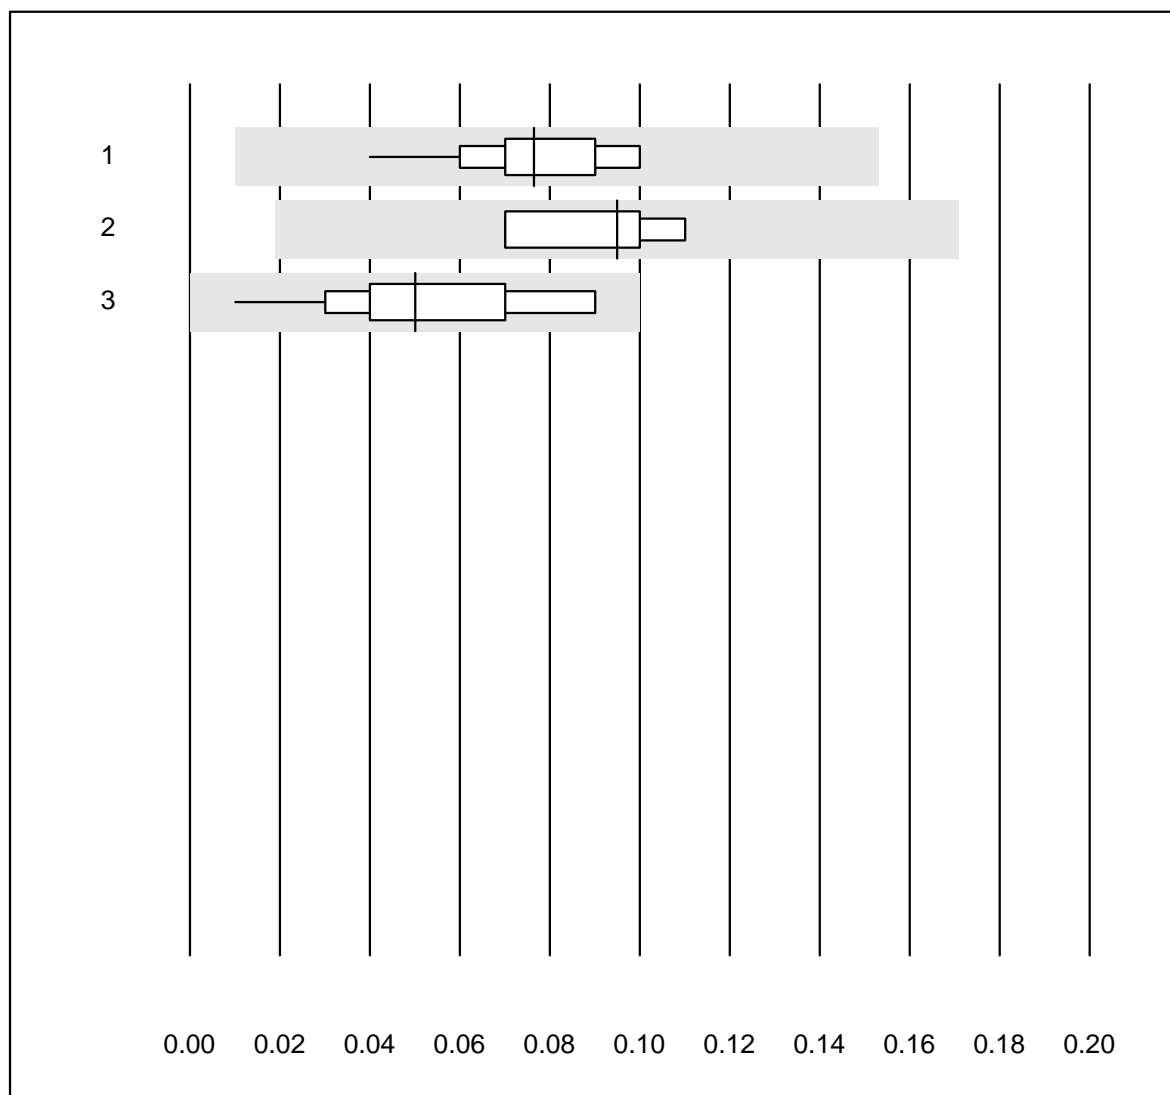


Tolérance MQ : 80 %

Eosinophiles (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	79	100.0	0.0	0.0	0.08	19.8	a
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	0.10	18.5	e
3 Yumizen/Pentra	16	100.0	0.0	0.0	0.05	41.0	a

Basophiles

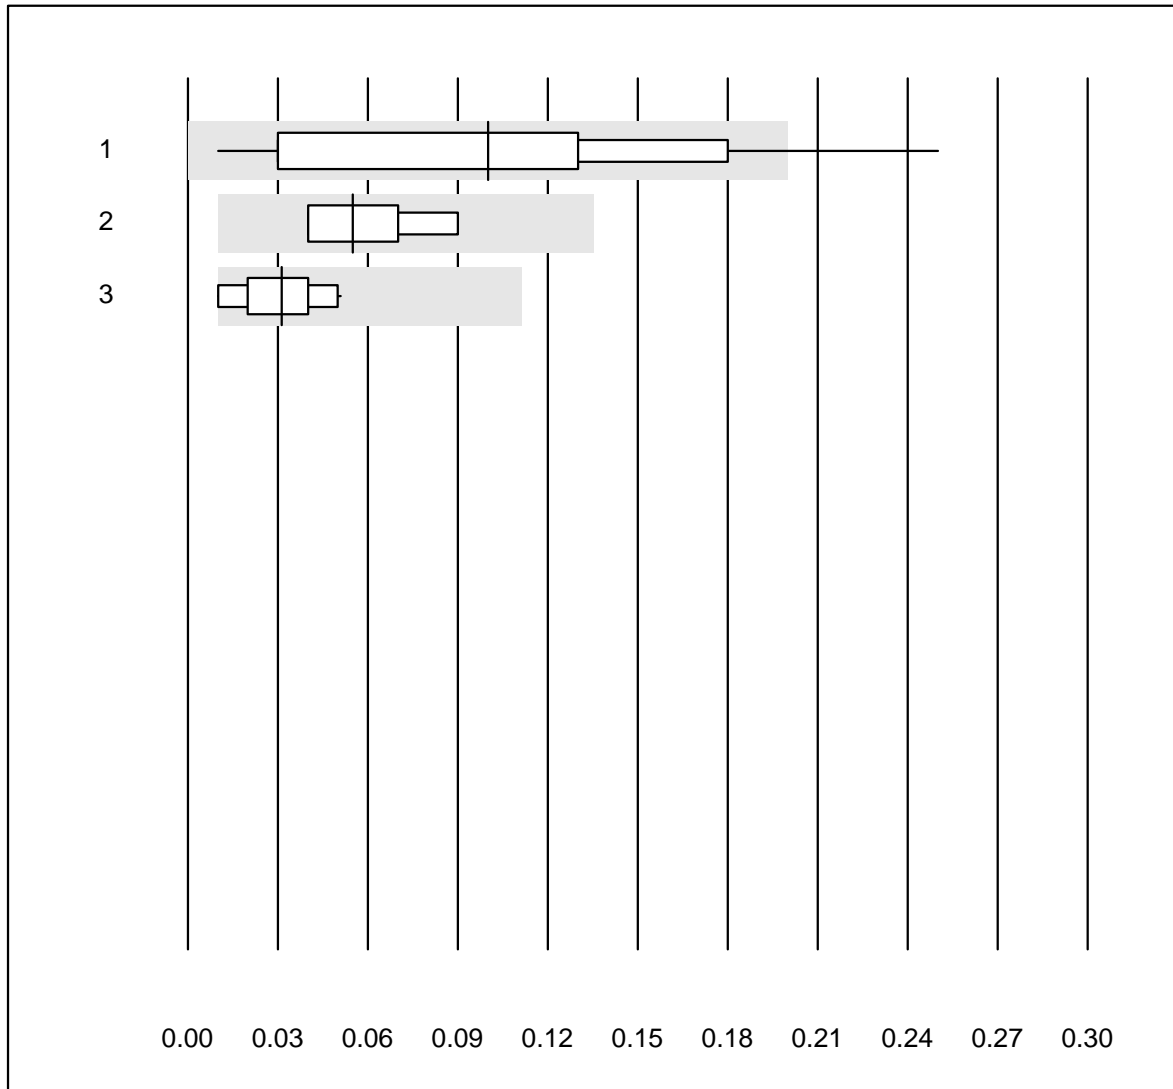


Tolérance MQ : 80 %
(< 0.10: +/- 0.08 G/l)

Basophiles (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	79	94.9	5.1	0.0	0.10	68.7	a
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	0.06	40.8	e*
3 Yumizen/Pentra	16	100.0	0.0	0.0	0.03	48.2	e*

MCV

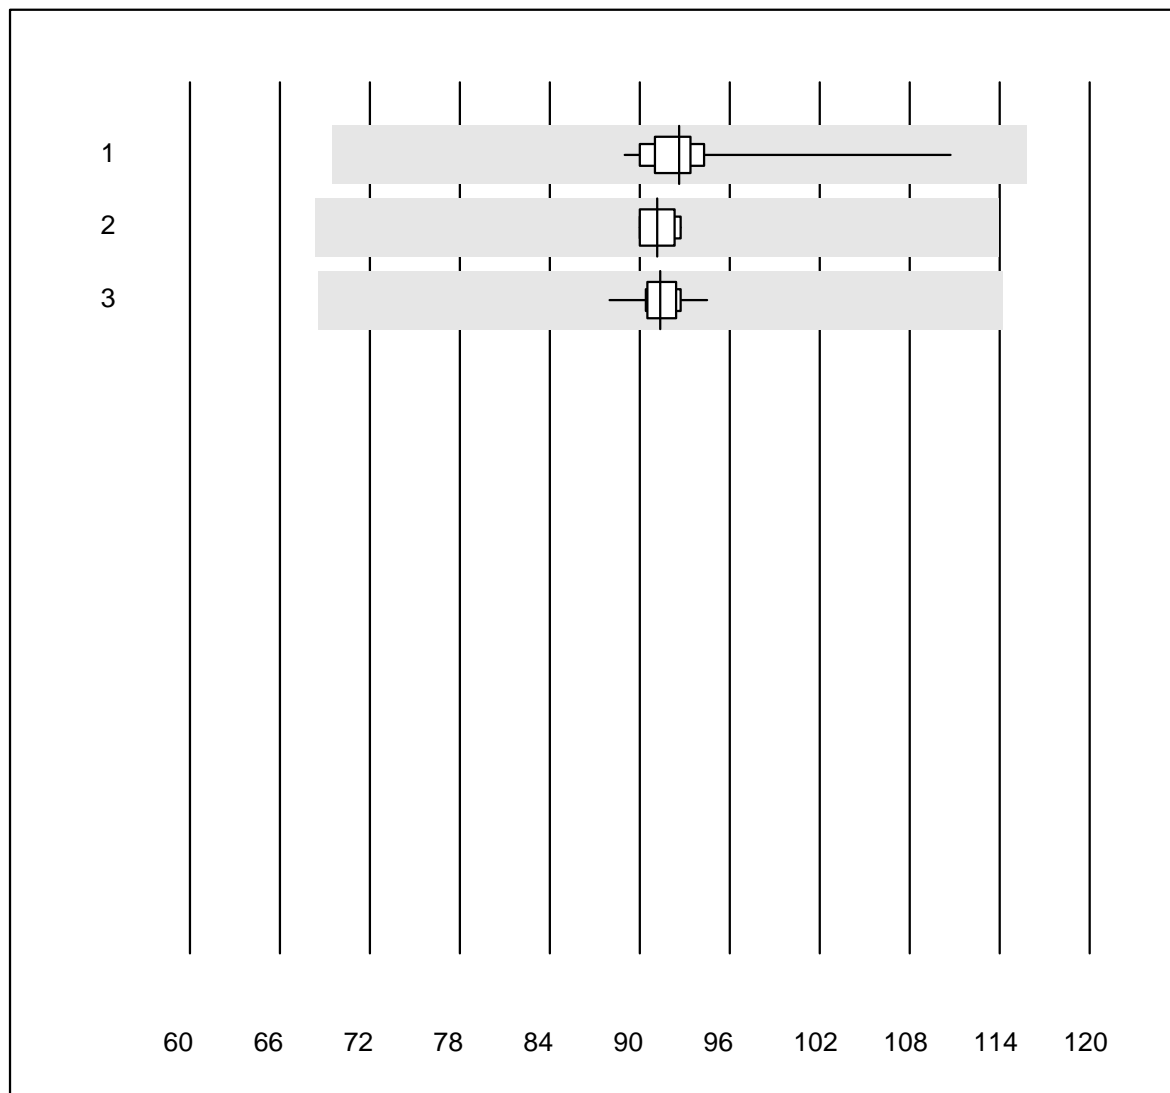


Tolérance MQ : 25 %

MCV (fl)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	74	100.0	0.0	0.0	92.6	3.5	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	91.2	1.6	e
3 Yumizen/Pentra	11	100.0	0.0	0.0	91.3	1.8	e

MCH

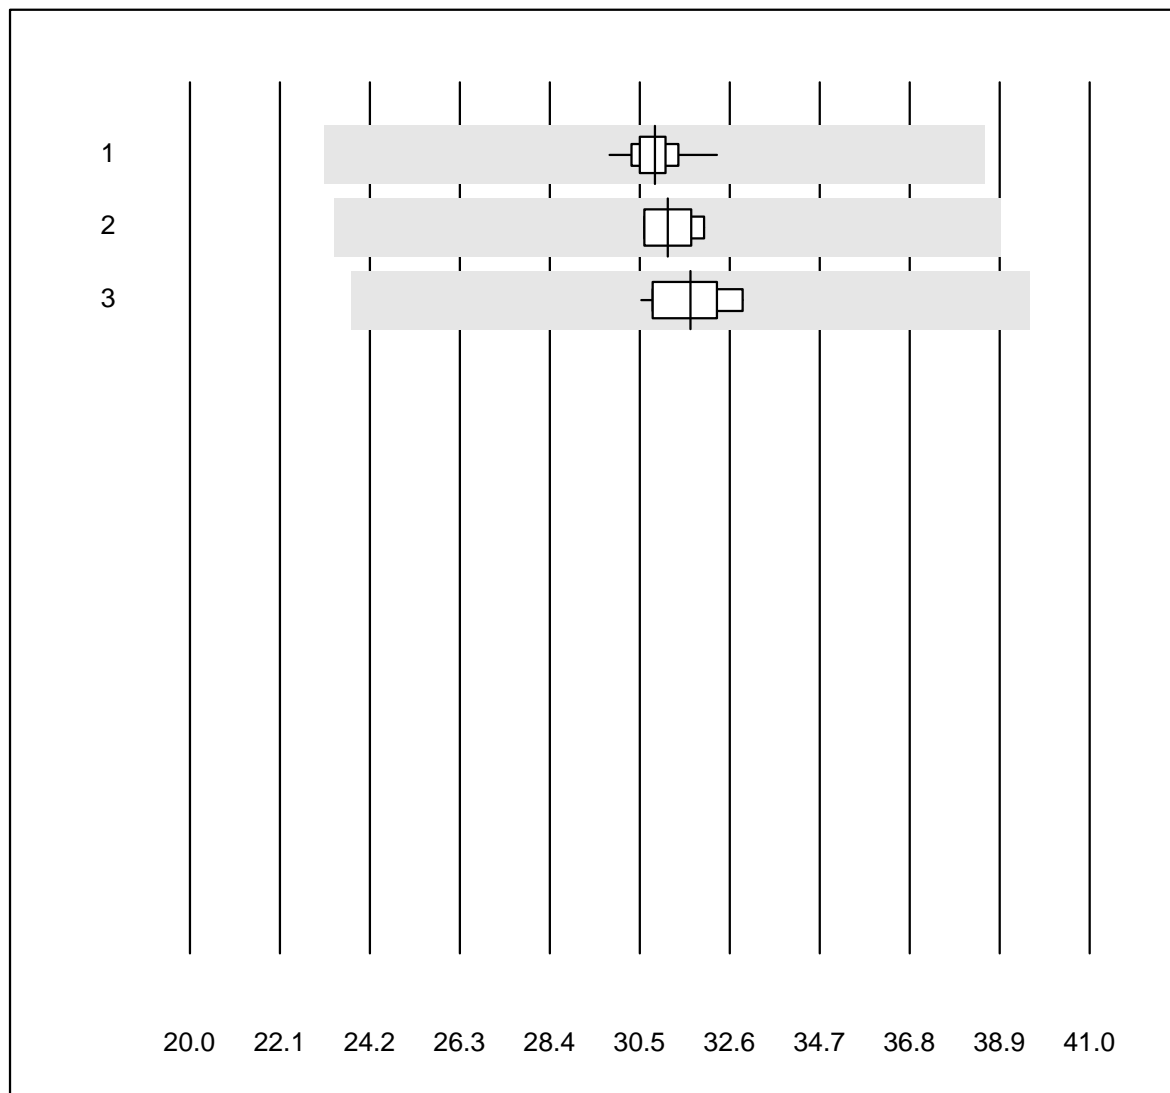


Tolérance MQ : 25 %

MCH (pg)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	74	100.0	0.0	0.0	30.8	1.5	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	31.2	2.3	e
3 Yumizen/Pentra	11	100.0	0.0	0.0	31.7	2.7	e

MCHC

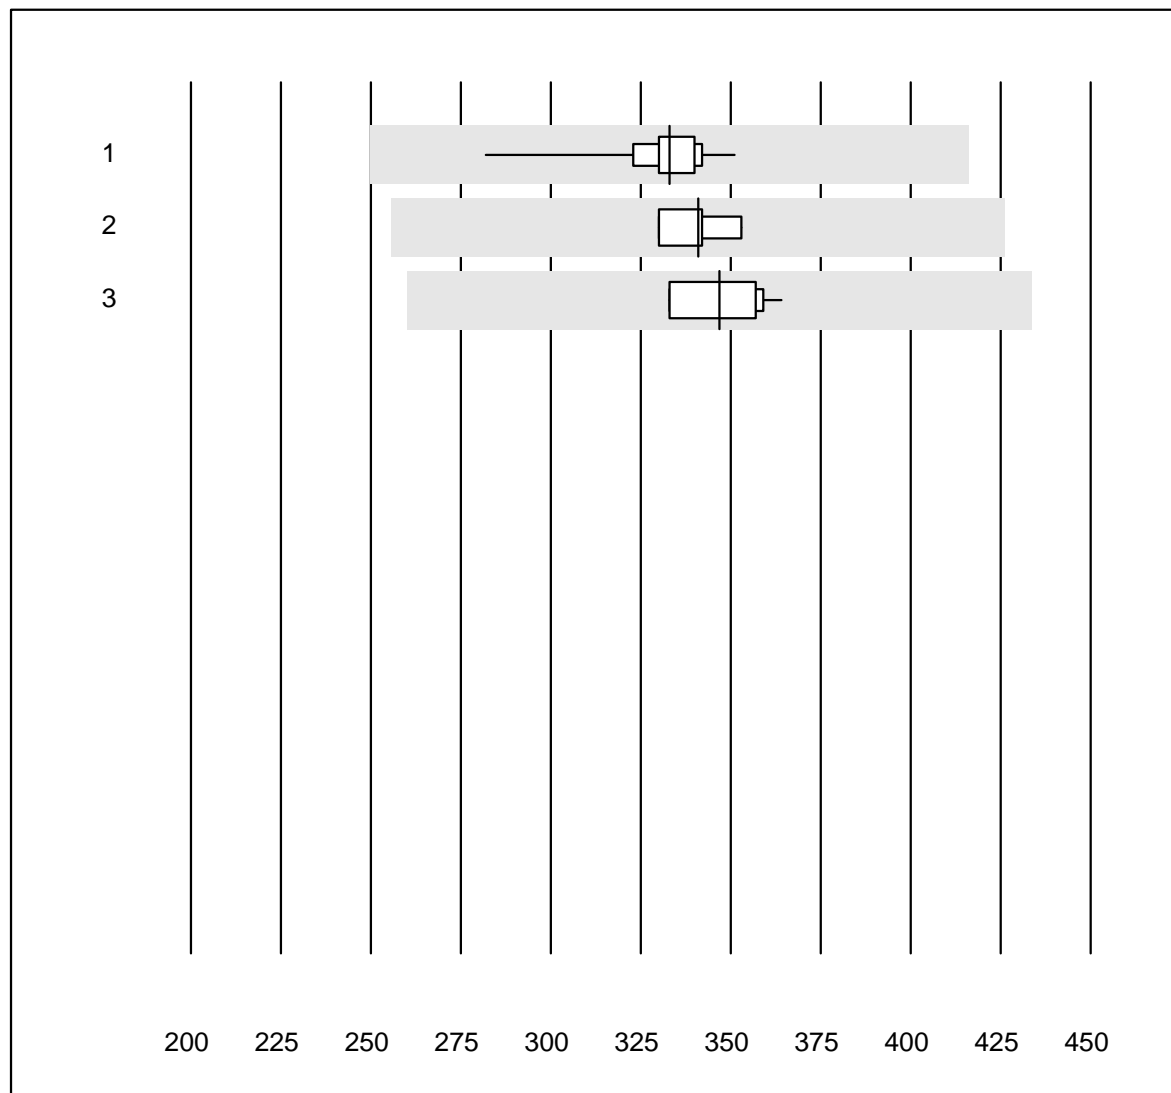


Tolérance MQ : 25 %

MCHC (g/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	74	100.0	0.0	0.0	333	3.1	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	341	2.8	e
3 Yumizen/Pentra	11	100.0	0.0	0.0	347	3.2	e

RDW

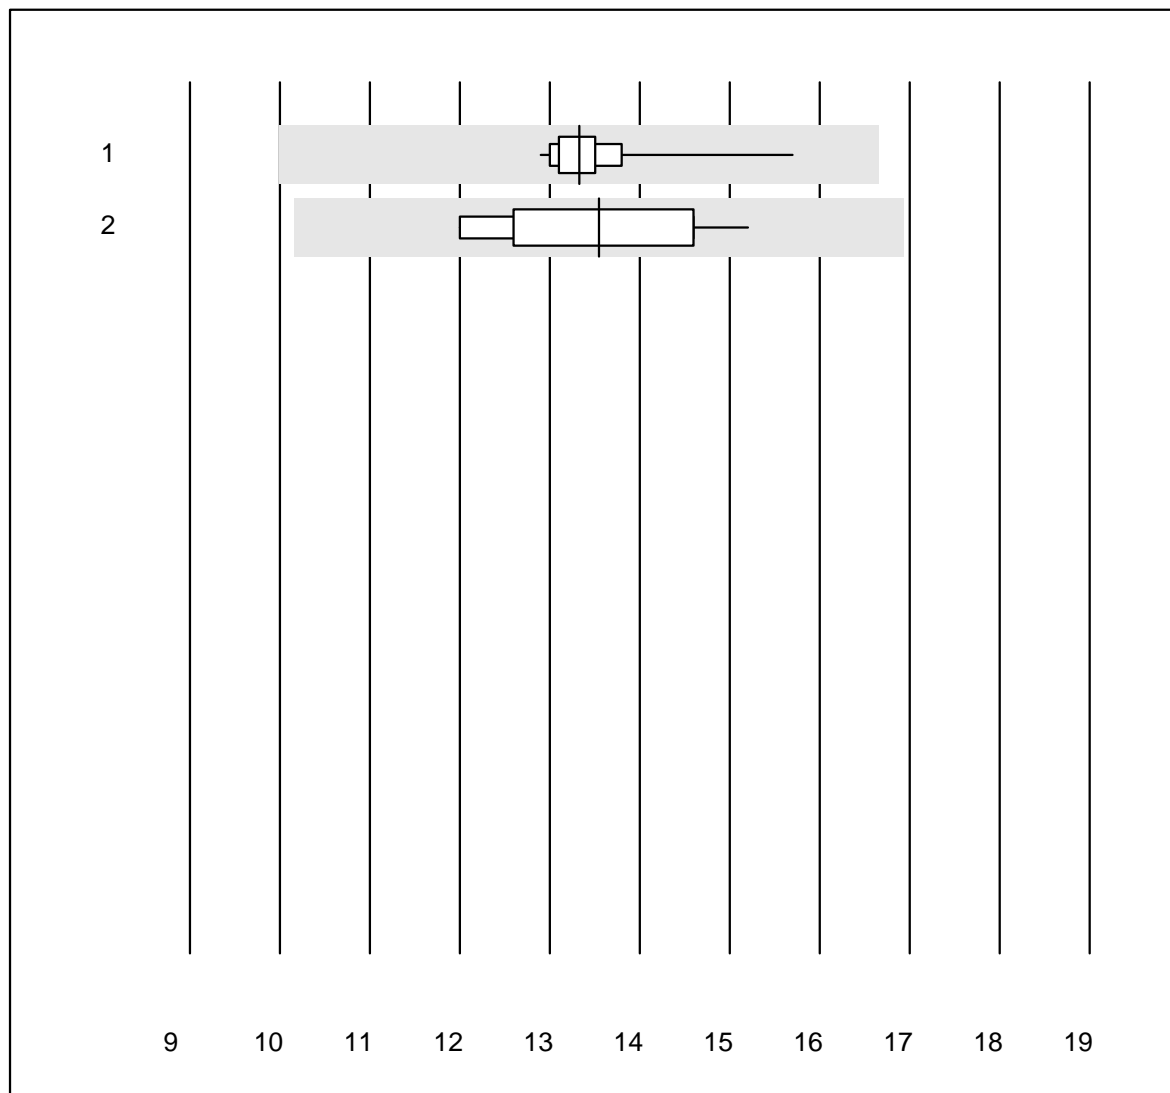


Tolérance MQ : 25 %

RDW (%)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	71	100.0	0.0	0.0	13.3	3.2	e
2 Yumizen/Pentra	10	100.0	0.0	0.0	13.5	8.1	e

Immature Granulocytes

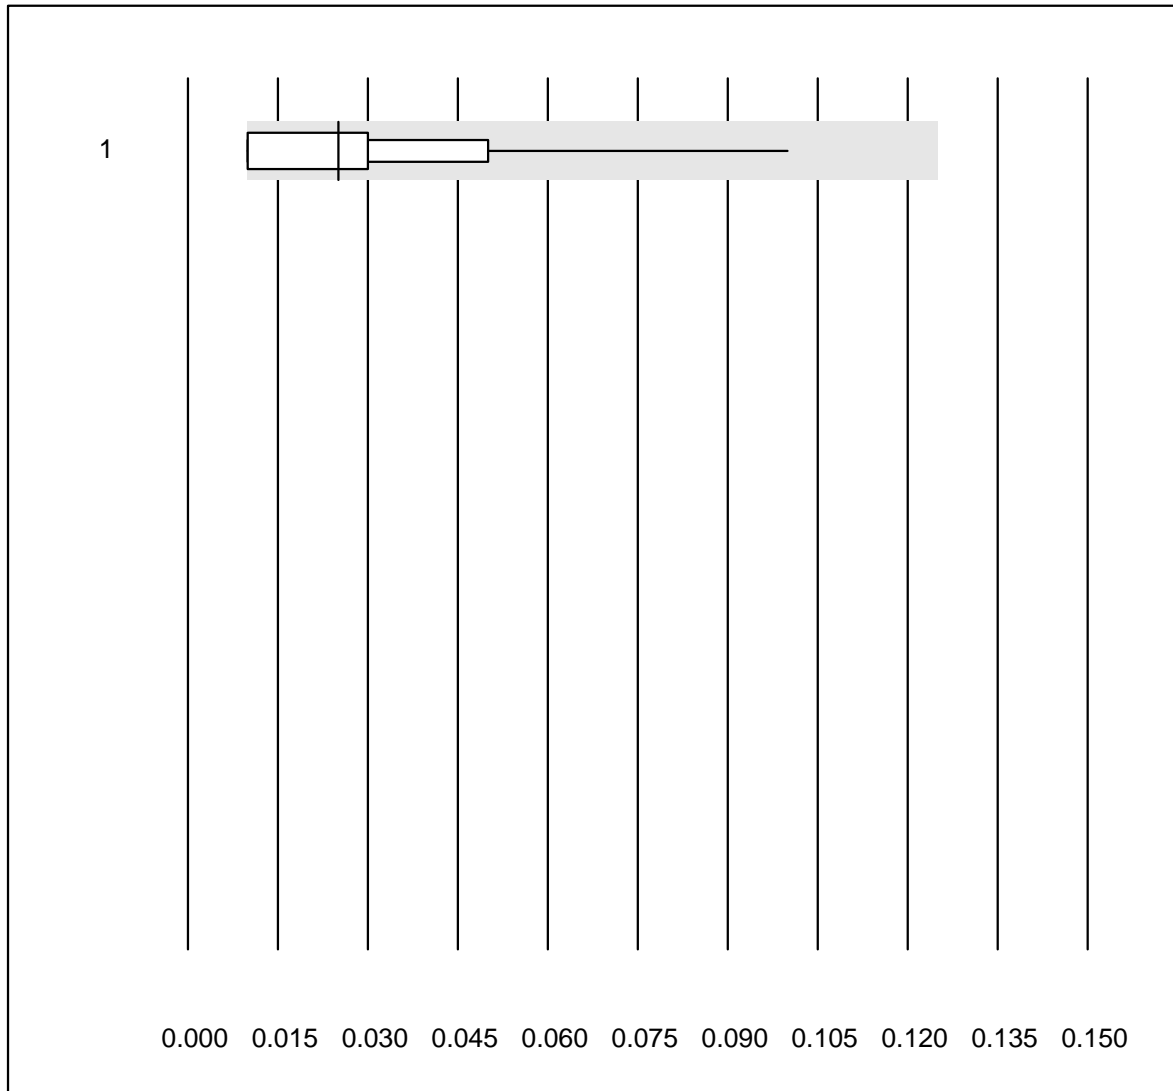


Tolérance MQ : 25 %
 (< 0.10: +/- 0.10 G/l)

Immature Granulocytes (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	60	98.3	0.0	1.7	0.03	65.1	e*

Réticulocytes

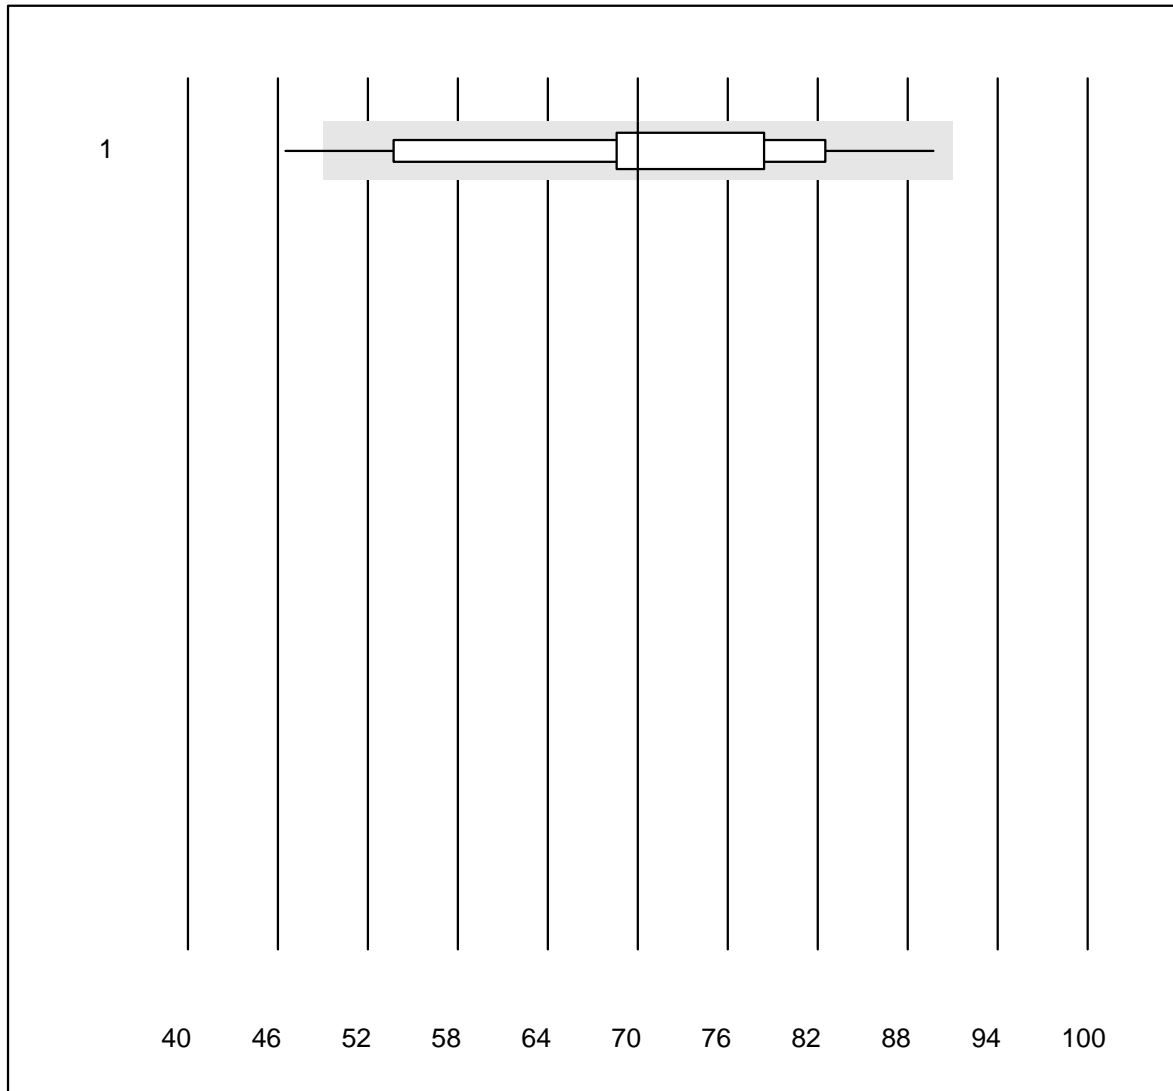


Tolérance MQ : 30 %

Réticulocytes (G/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	39	94.8	2.6	2.6	70.0	13.5	a

Index hémolytique échantillon A

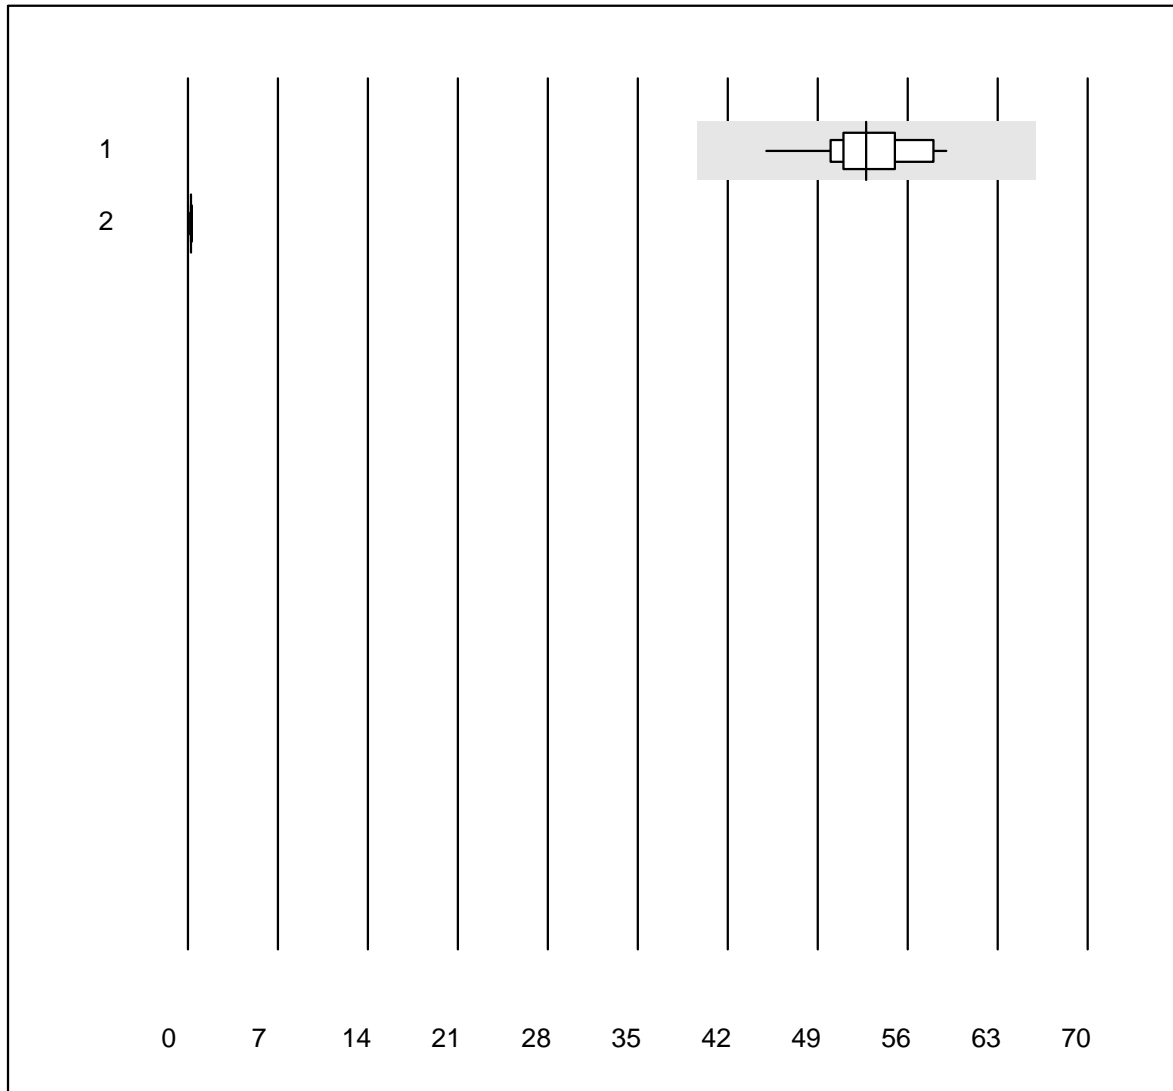


Tolérance MQ : 15 %

Index hémolytique échantillon A ()

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	52.76	6.4	a
2 Architect	6	100.0	0.0	0.0	0.26	14.0	a

Index hémolytique échantillon B

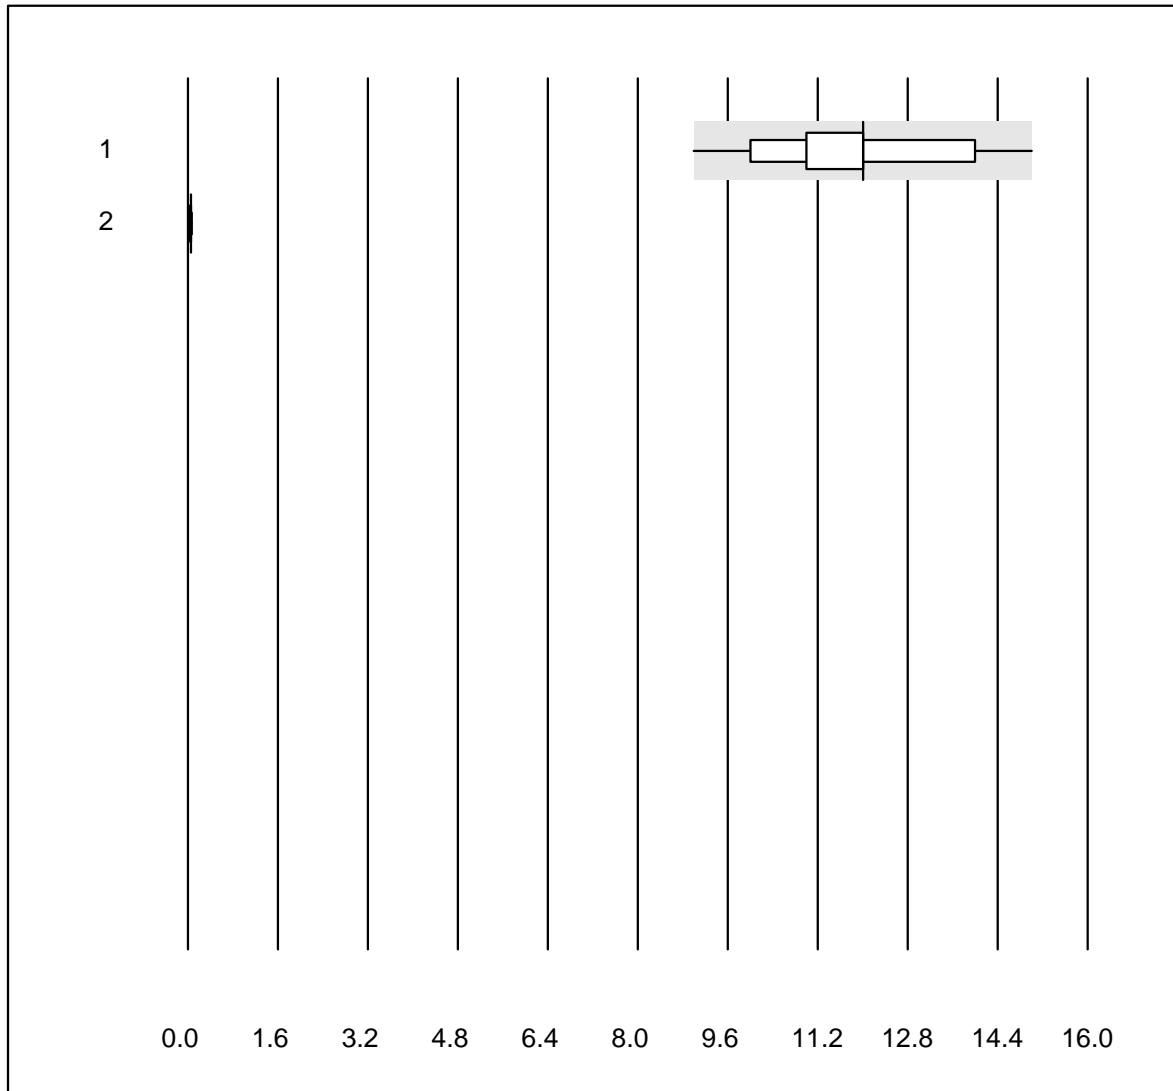


Tolérance MQ : 15 %

Index hémolytique échantillon B ()

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	18	88.9	11.1	0.0	12.00	12.7	a
2 Architect	6	83.3	16.7	0.0	0.05	22.6	a

Vitesse de sédimentation 1h

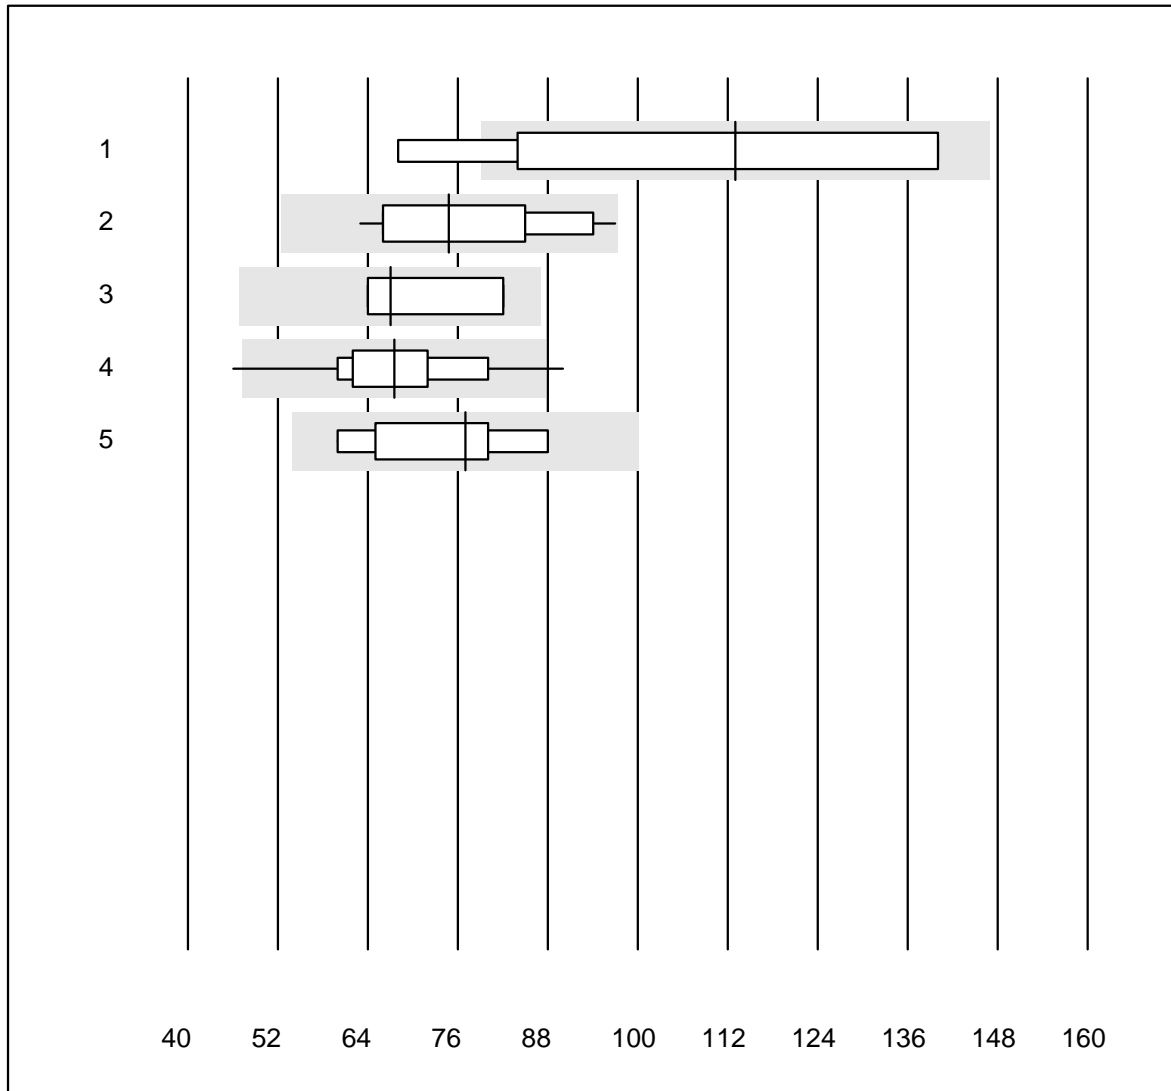


Tolérance MQ : 30 %

Vitesse de sédimentation 1h (mm/h)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 MINI-CUBE	9	88.9	11.1	0.0	113	26.4	e*
2 Sarstedt Sedivette	11	100.0	0.0	0.0	75	15.8	e*
3 Sarstedt Microvette	4	75.0	0.0	25.0	67	12.7	e*
4 BD Seditainer	42	88.1	4.8	7.1	68	12.7	e
5 Autres méthodes	6	100.0	0.0	0.0	77	14.0	e*

Vitesse de sédimentation 2h

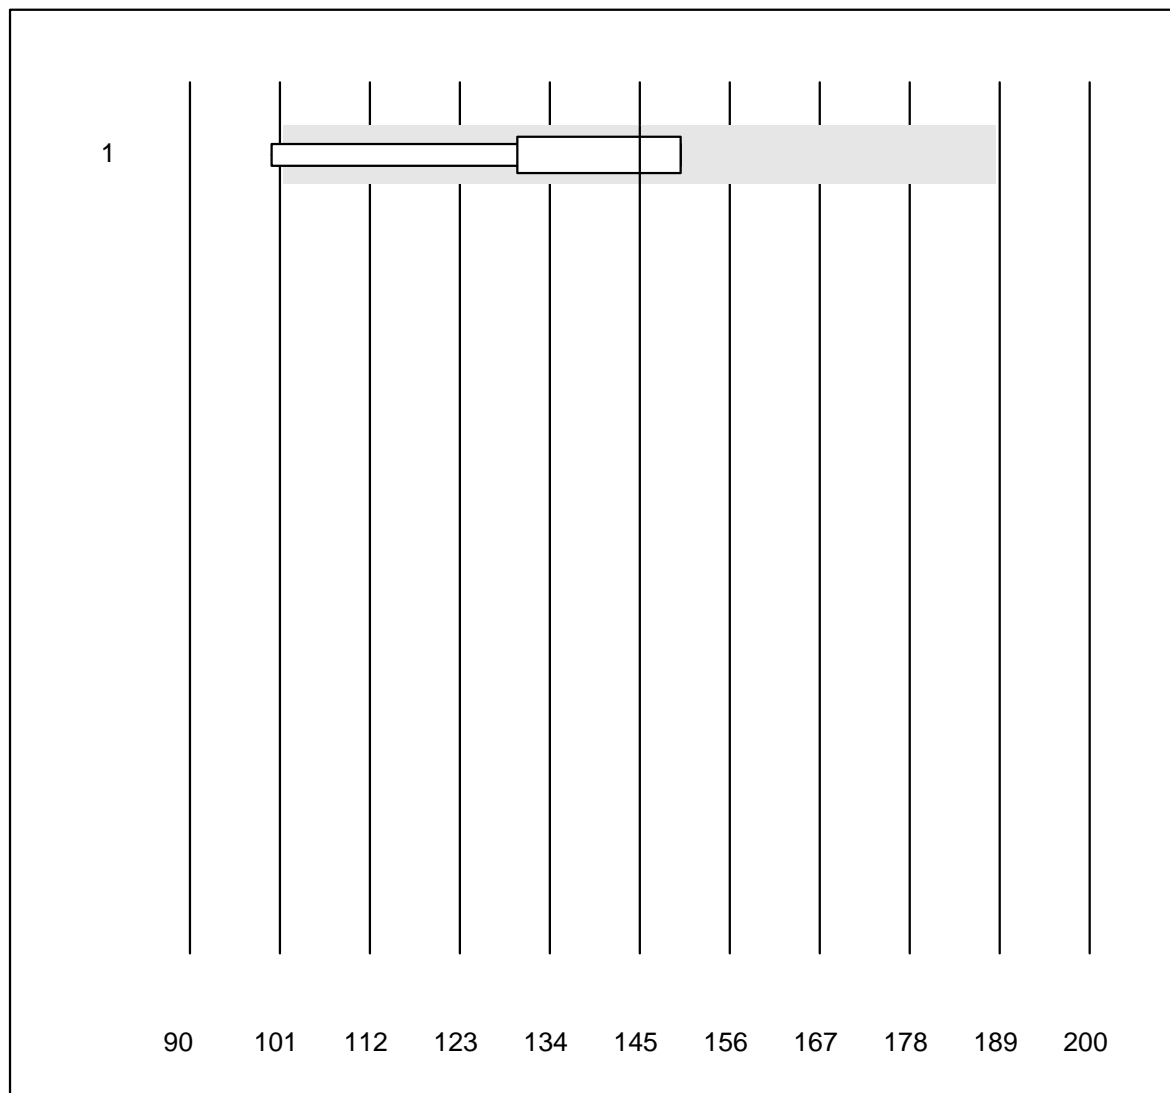


Tolérance MQ : 30 %

Vitesse de sédimentation 2h (mm/2h)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 BD Seditainer	6	83.3	16.7	0.0	145	14.4	e*

Hémoglobine HS

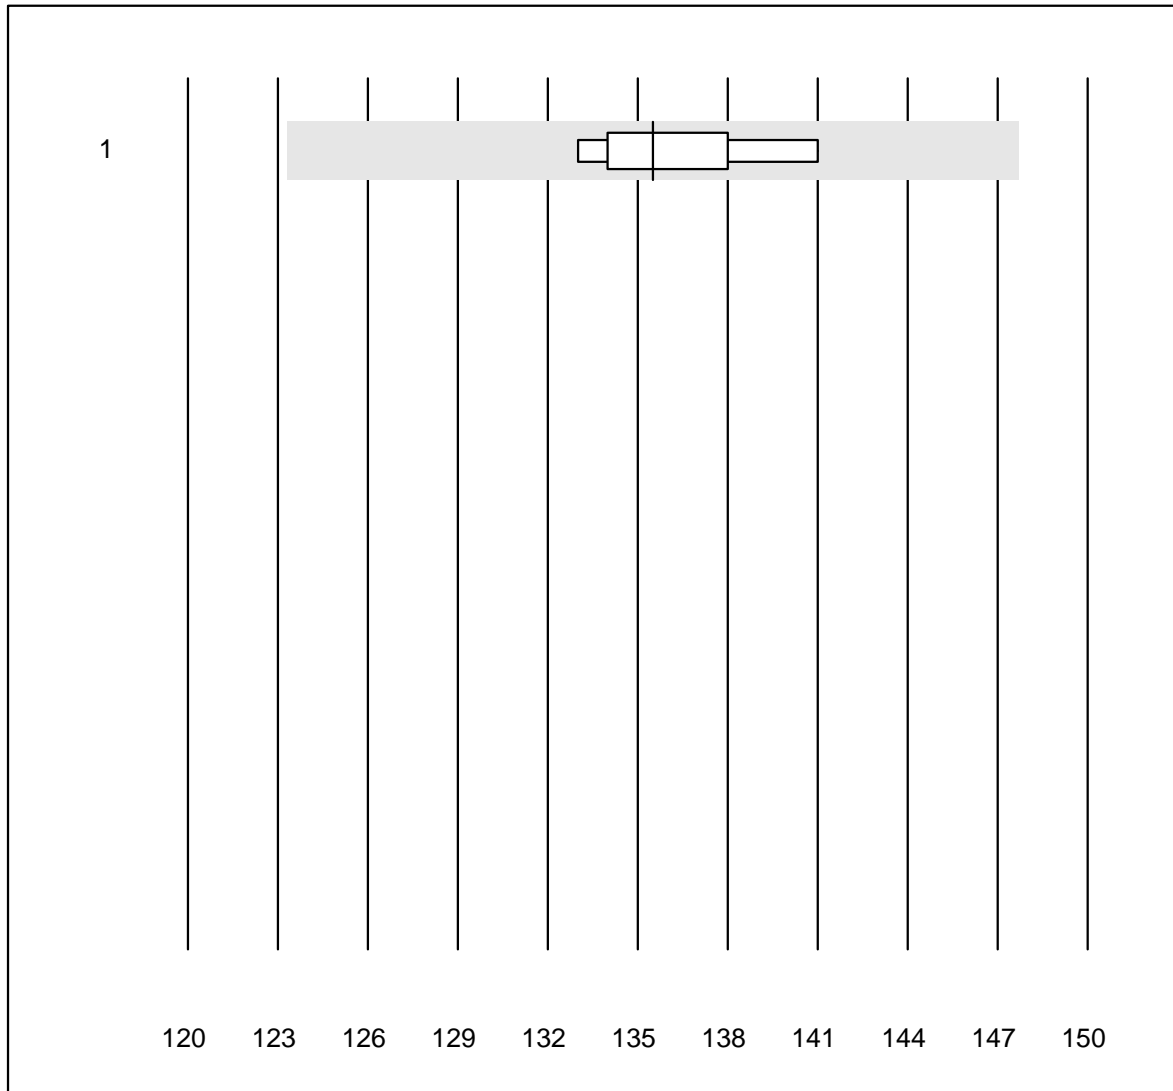


Tolérance MQ : 9 %

Hémoglobine HS (g/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 PixCell HemoScreen	6	83.3	0.0	16.7	135.5	2.3	e

Hématocrit HS

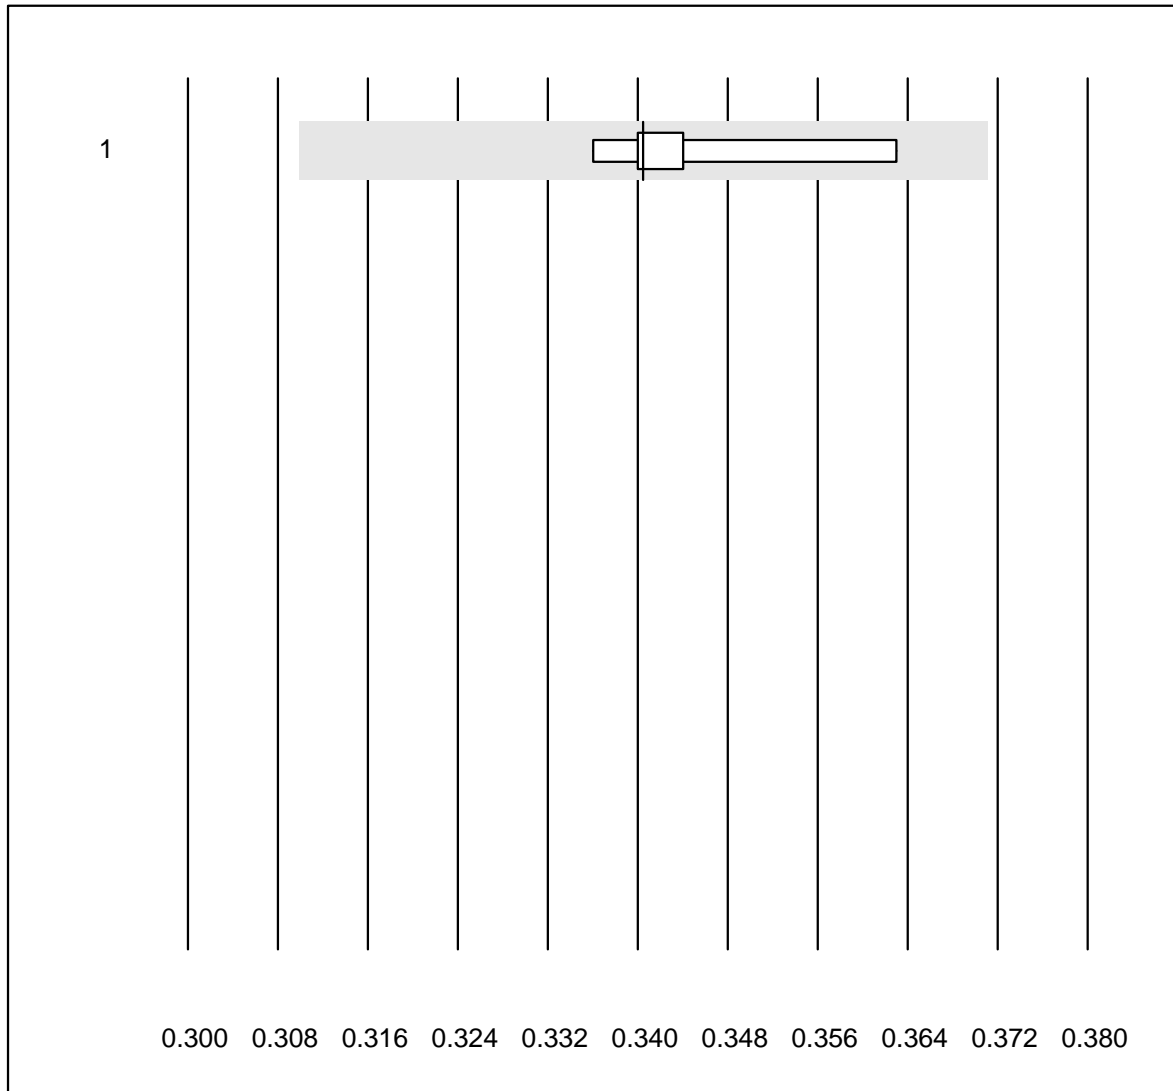


Tolérance MQ : 9 %

Hématocrit HS (l/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 PixCell HemoScreen	6	83.3	0.0	16.7	0.3	3.1	e*

Erythrocytes HS

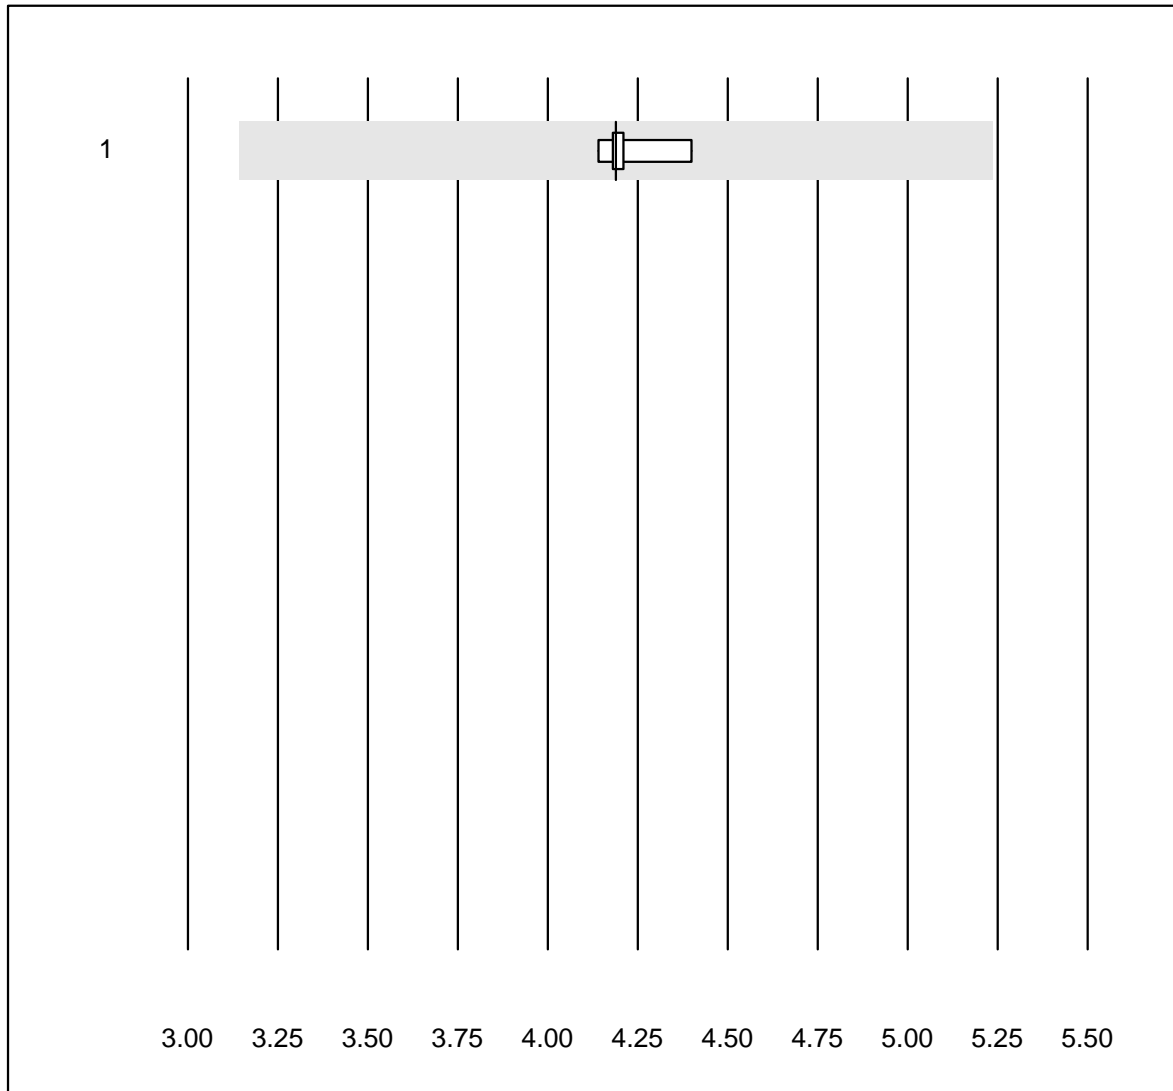


Tolérance MQ : 25 %

Erythrocytes HS (T/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 PixCell HemoScreen	6	83.3	0.0	16.7	4.19	2.4	e

Leucocytes HS

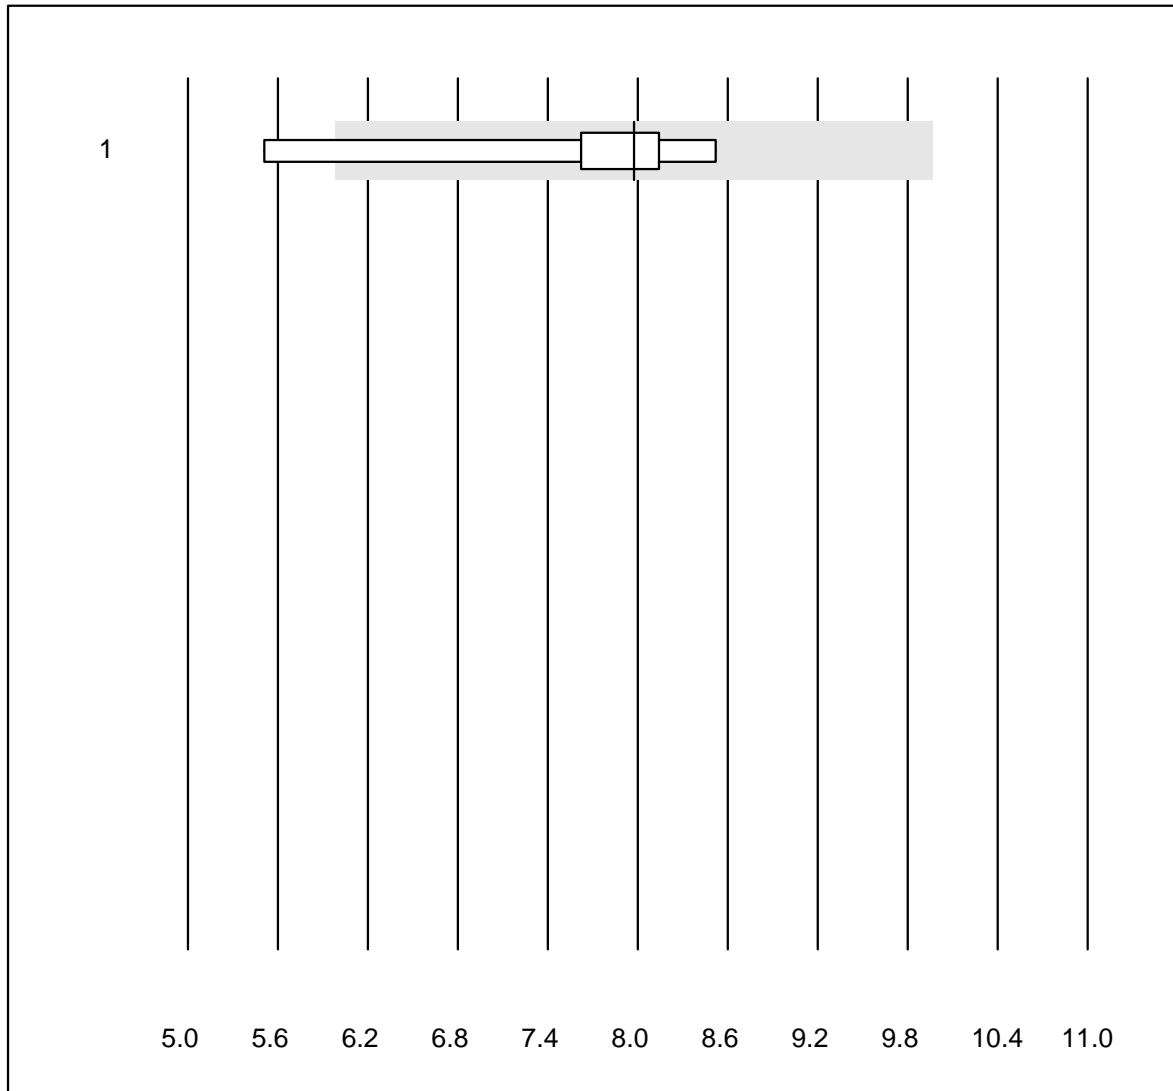


Tolérance MQ : 25 %

Leucocytes HS (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 PixCell HemoScreen	6	83.3	16.7	0.0	7.98	14.1	e*

Thrombocytes HS

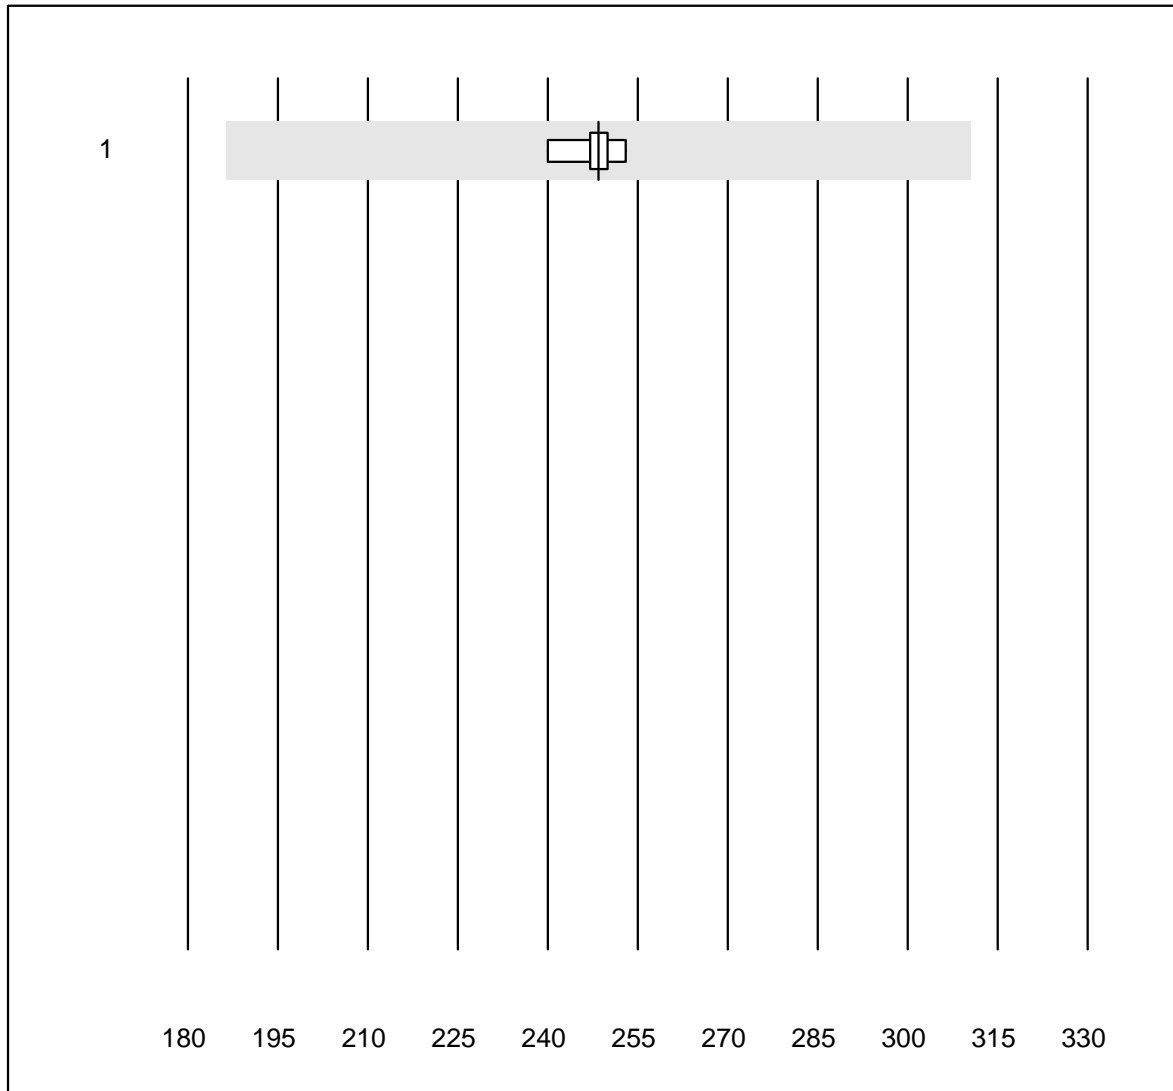


Tolérance MQ : 25 %

Thrombocytes HS (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 PixCell HemoScreen	6	100.0	0.0	0.0	248.5	1.8	e

Neutrophiles HS

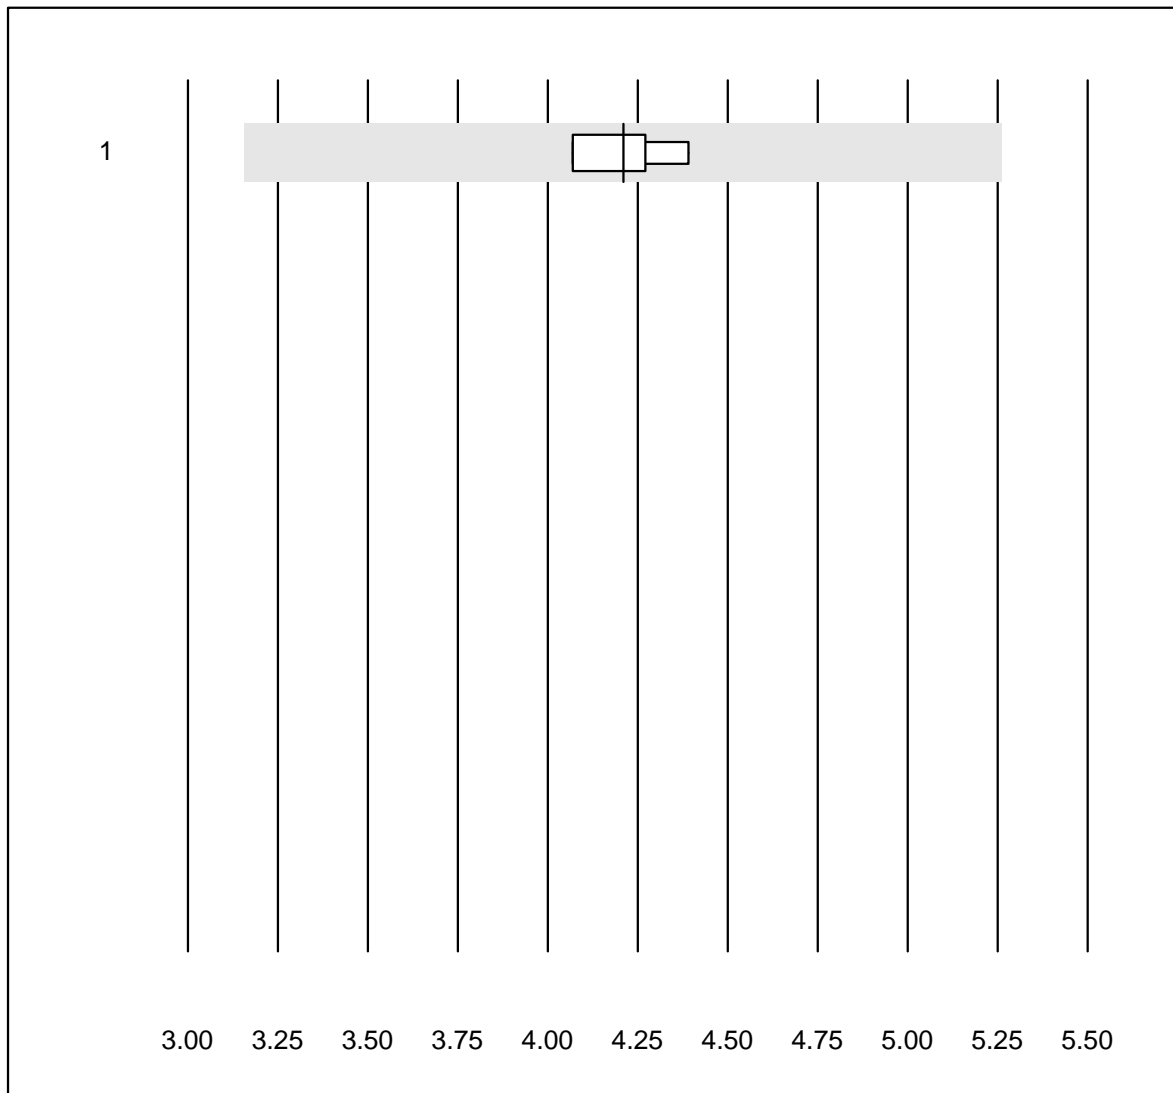


Tolérance MQ : 25 %

Neutrophiles HS (G/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 PixCell HemoScreen	5	80.0	0.0	20.0	4.21	3.1	e

Lymphocytes HS

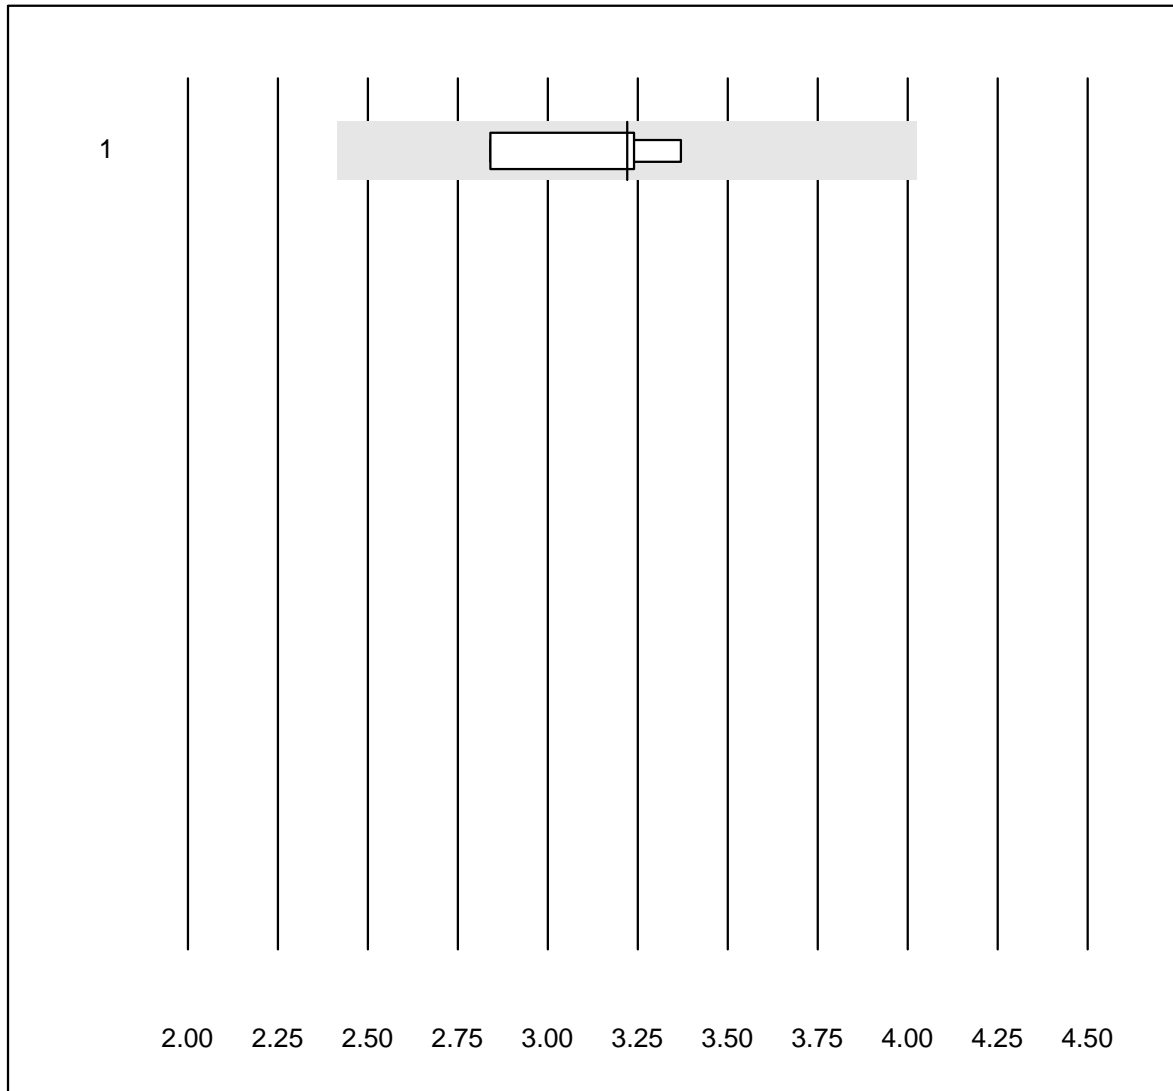


Tolérance MQ : 25 %

Lymphocytes HS (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 PixCell HemoScreen	5	80.0	0.0	20.0	3.22	7.2	e*

Monocytes HS

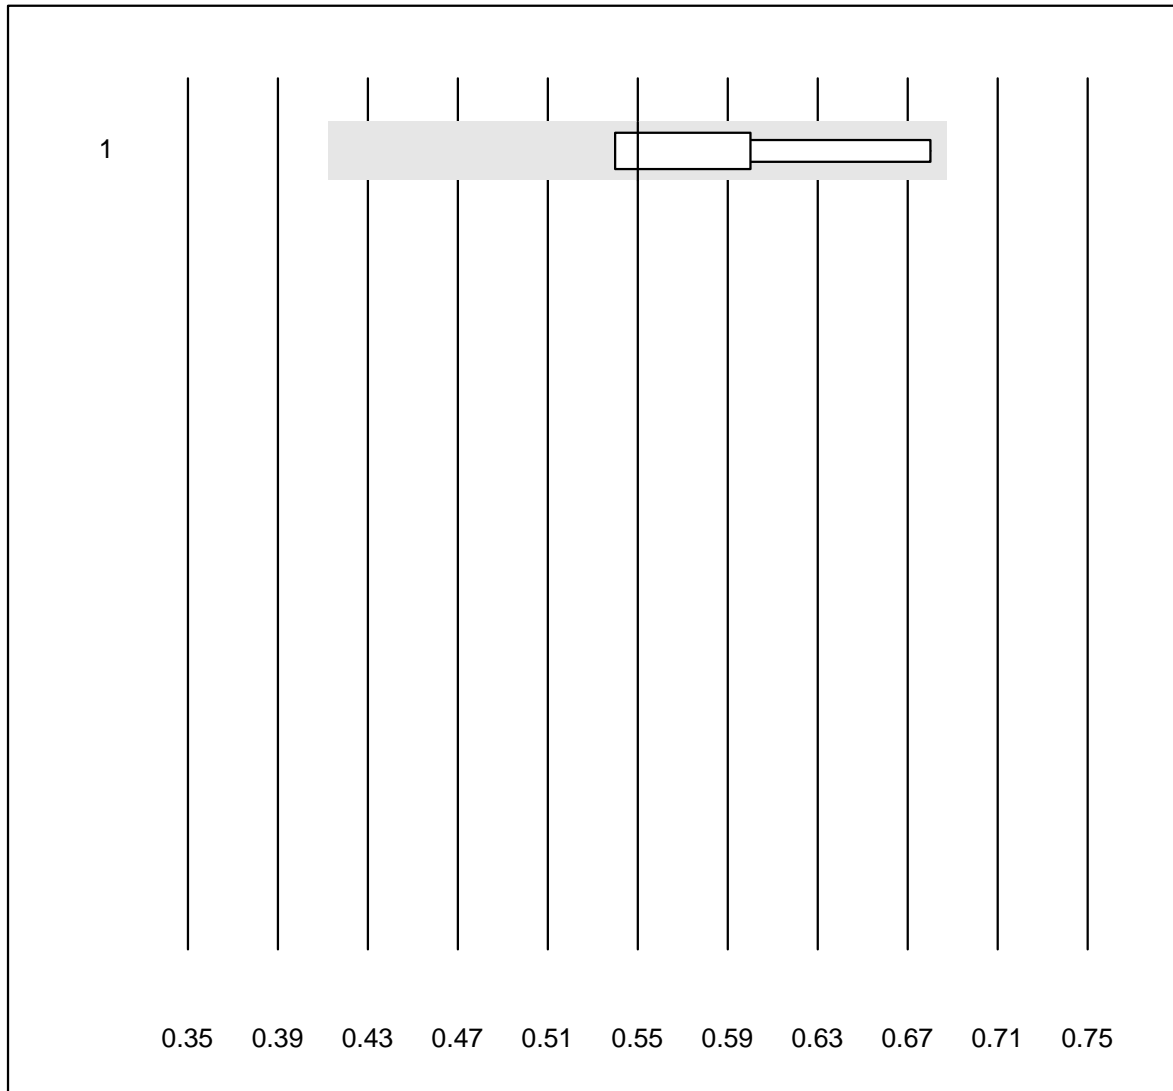


Tolérance MQ : 25 %

Monocytes HS (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 PixCell HemoScreen	5	80.0	0.0	20.0	0.55	10.8	e*

Eosinophiles HS

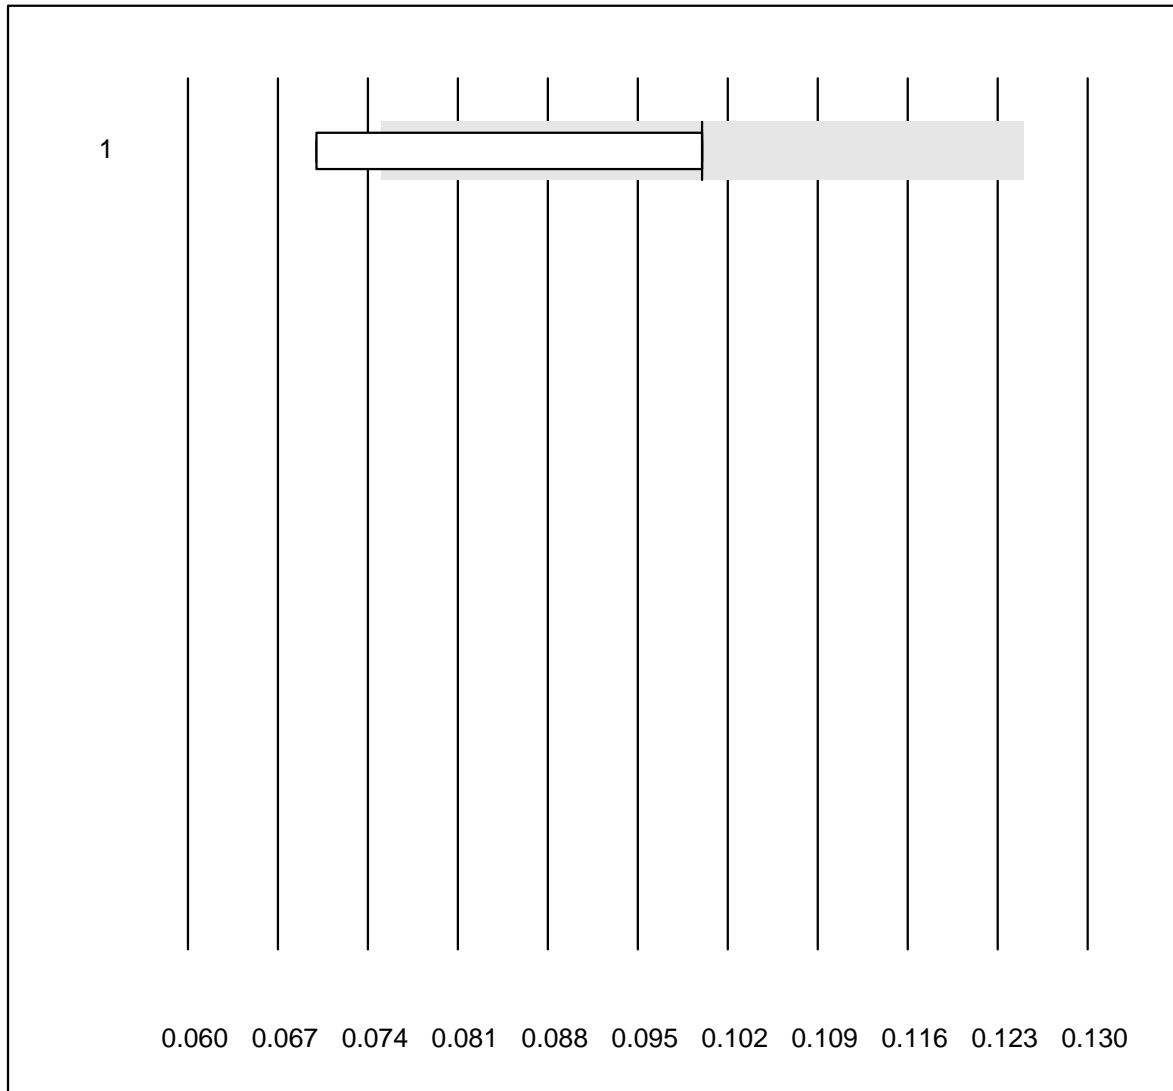


Tolérance MQ : 25 %

Eosinophiles HS (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 PixCell HemoScreen	5	20.0	20.0	60.0	0.10	25.0	e*

Basophiles HS

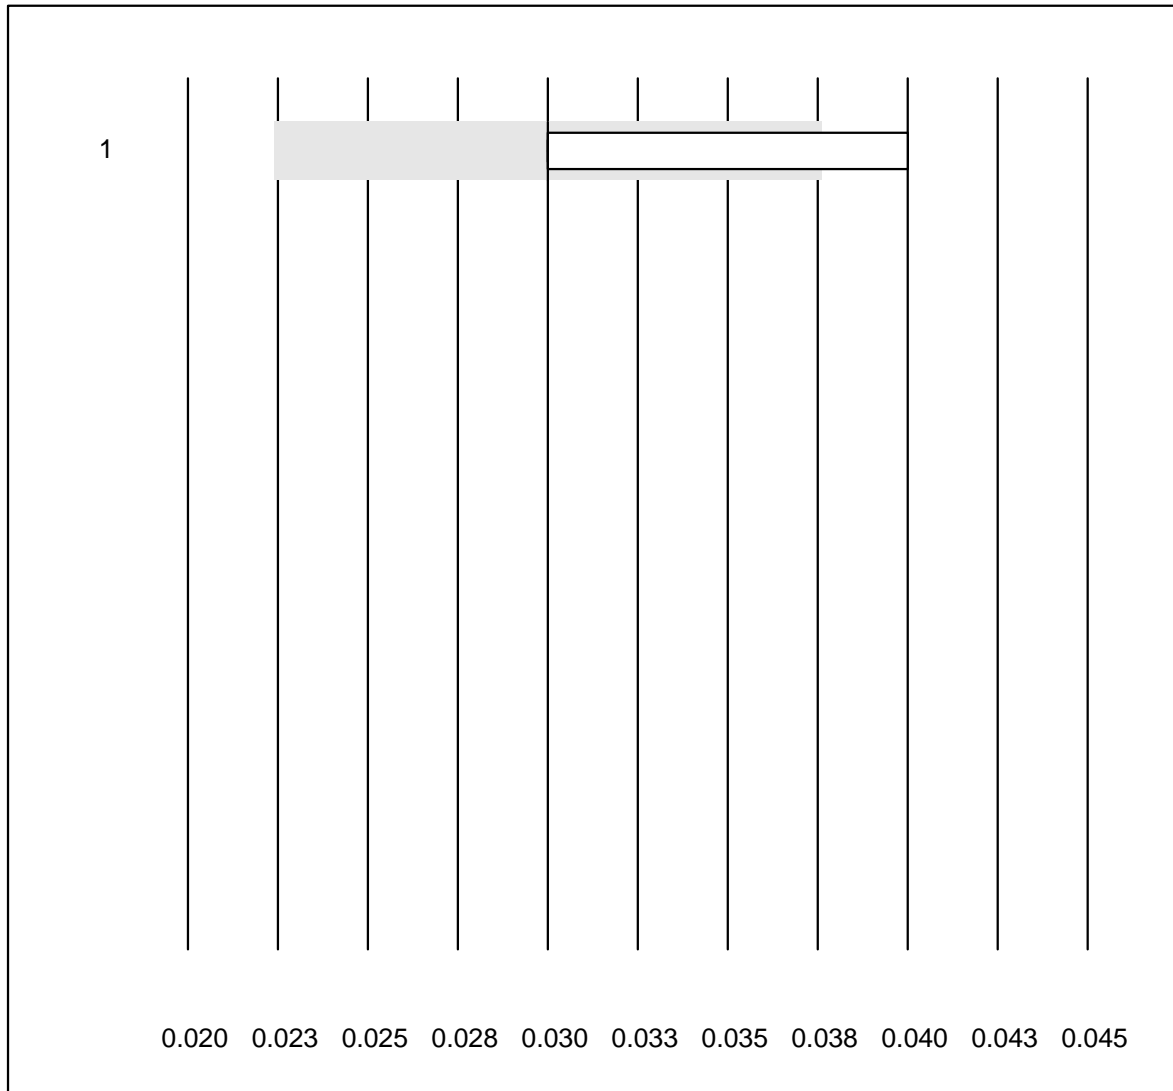


Tolérance MQ : 25 %

Basophiles HS (G/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 PixCell HemoScreen	5	40.0	40.0	20.0	0.03	16.5	e*

CRP

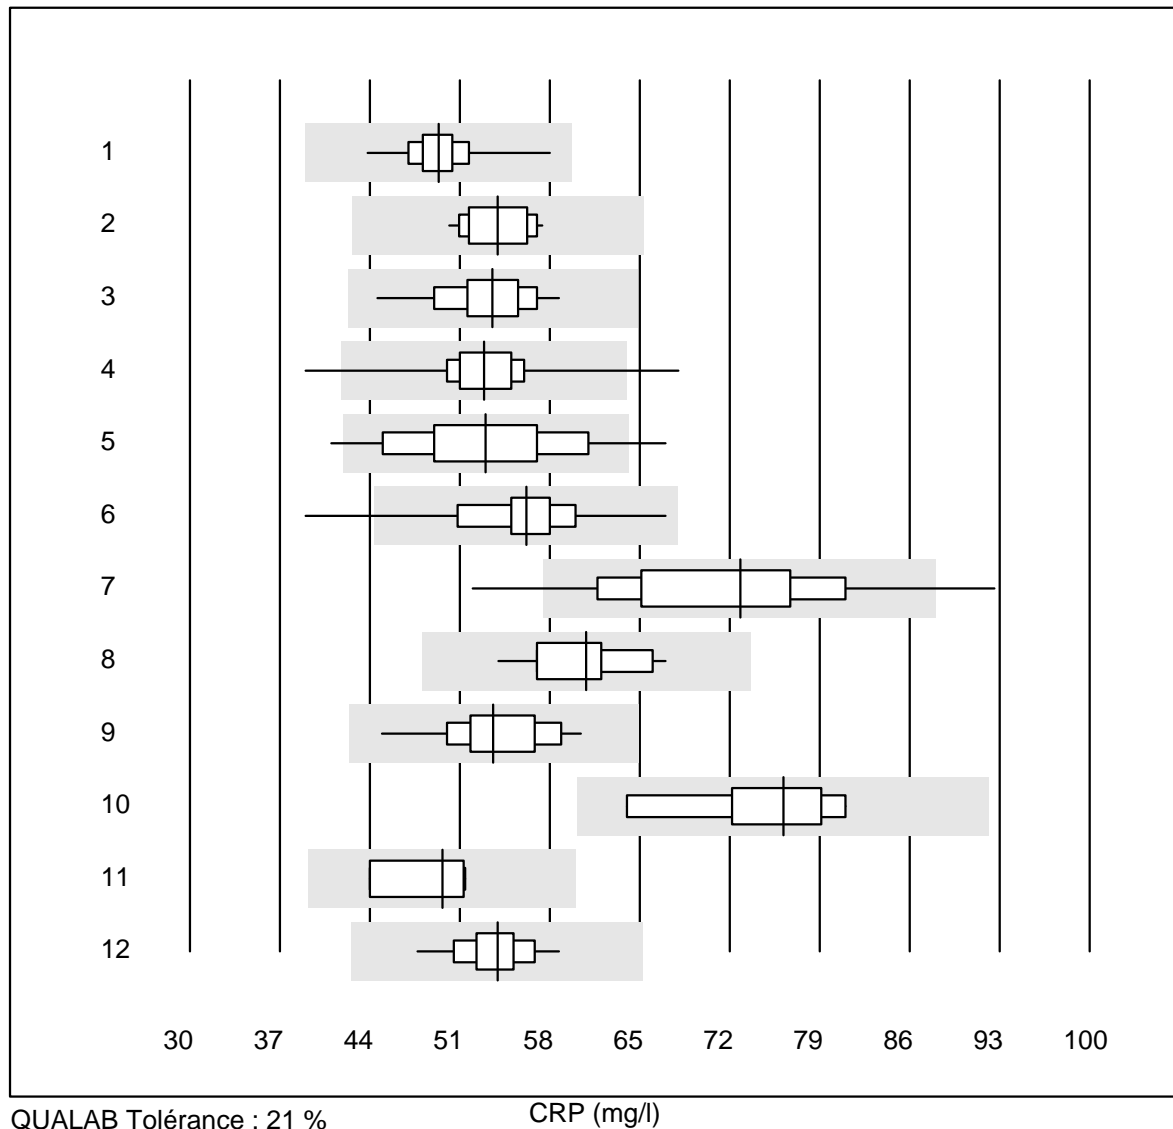


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas b101	301	98.7	0.0	1.3	49.3	3.8	e
2 Cobas	22	100.0	0.0	0.0	54.0	4.5	e
3 Turbidimétrie	14	85.7	0.0	14.3	53.6	7.0	e
4 Afinion	1217	99.2	0.2	0.6	52.9	4.9	e
5 NycoCard SingleTest-	99	87.9	4.0	8.1	53.0	11.2	e
6 Quick Read go	102	97.0	1.0	2.0	56.2	6.9	e
7 Eurolyser	87	79.3	6.9	13.8	72.8	11.7	e
8 Fuji Dri-Chem	14	85.7	0.0	14.3	60.8	6.1	e
9 Autolyser/DiaSys	12	91.7	0.0	8.3	53.6	8.0	e
10 Piccolo	5	100.0	0.0	0.0	76.2	9.1	e*
11 Nephelométrie	4	100.0	0.0	0.0	49.7	7.2	e*
12 Celltac chemi	46	97.8	0.0	2.2	53.9	4.4	e

CRP

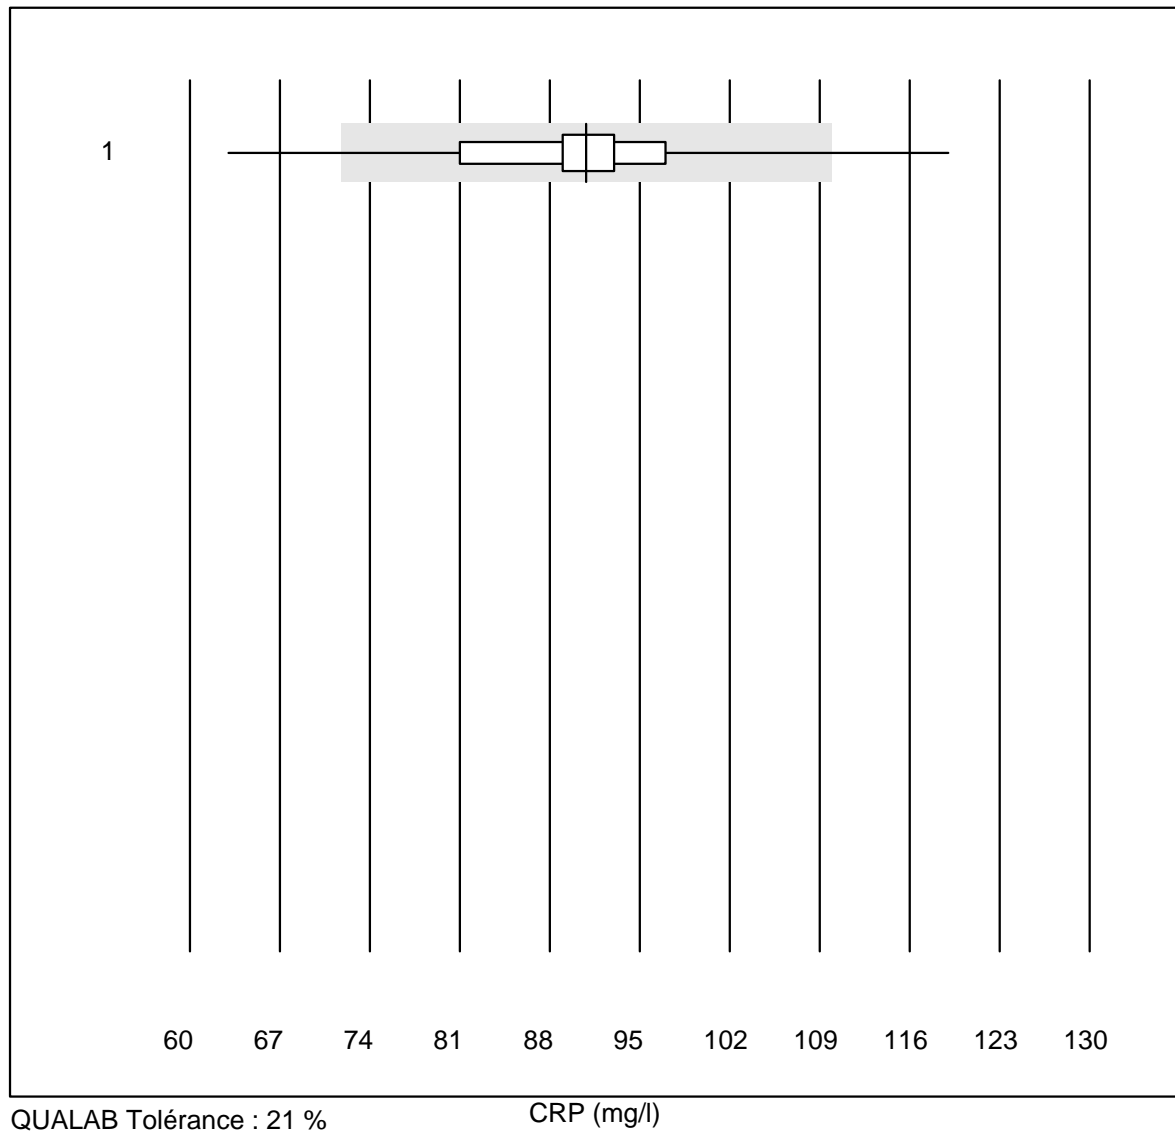


No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 QuickRead (sang comp	30	83.3	6.7	10.0	90.9	9.6	e

CRP

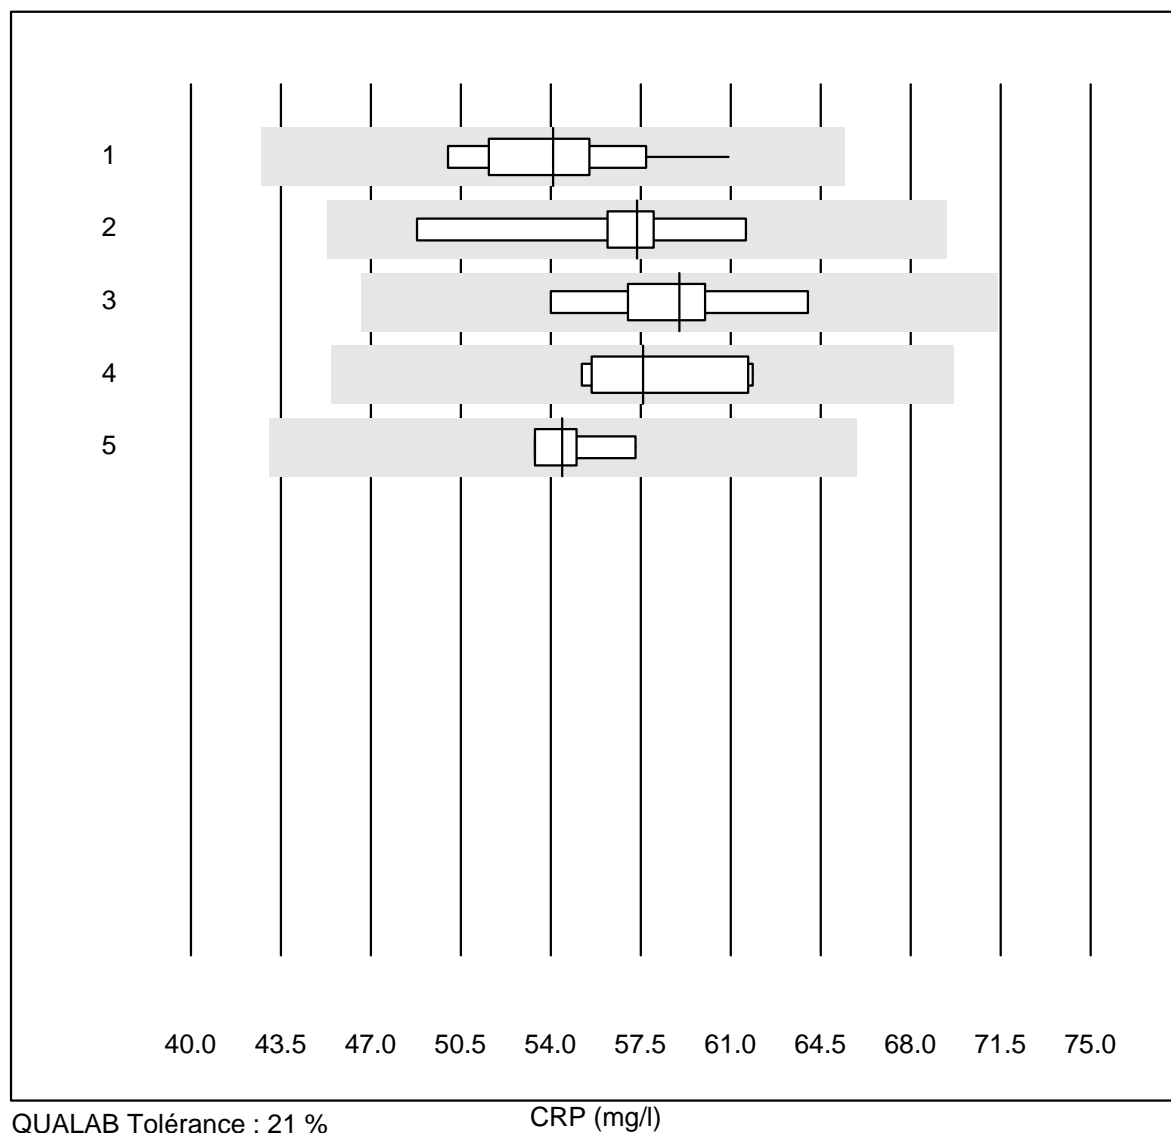


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Spinit	10	100.0	0.0	0.0	54.1	6.2	e
2 Architect	8	100.0	0.0	0.0	57.4	6.5	e
3 AQT 90 FLEX	9	100.0	0.0	0.0	59.0	5.3	e
4 Spotchem D-Concept	6	100.0	0.0	0.0	57.6	5.3	e
5 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	54.5	3.2	e

IgG

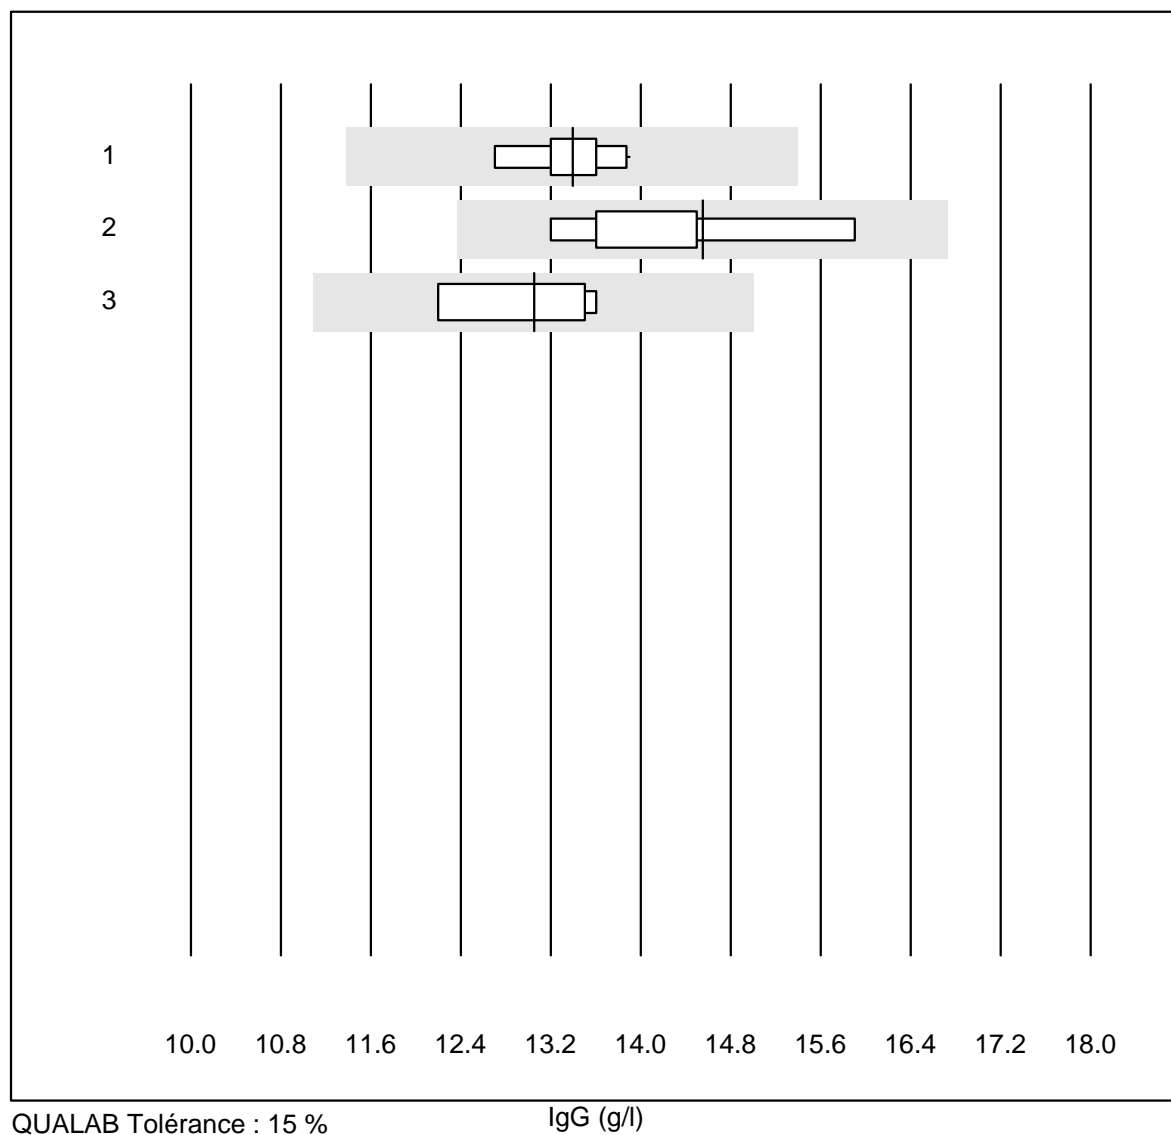

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Turbidimétrie	17	100.0	0.0	0.0	13.39	2.5	e
2 Néphélométrie	5	100.0	0.0	0.0	14.55	7.5	a
3 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	13.05	5.3	e*

IgA

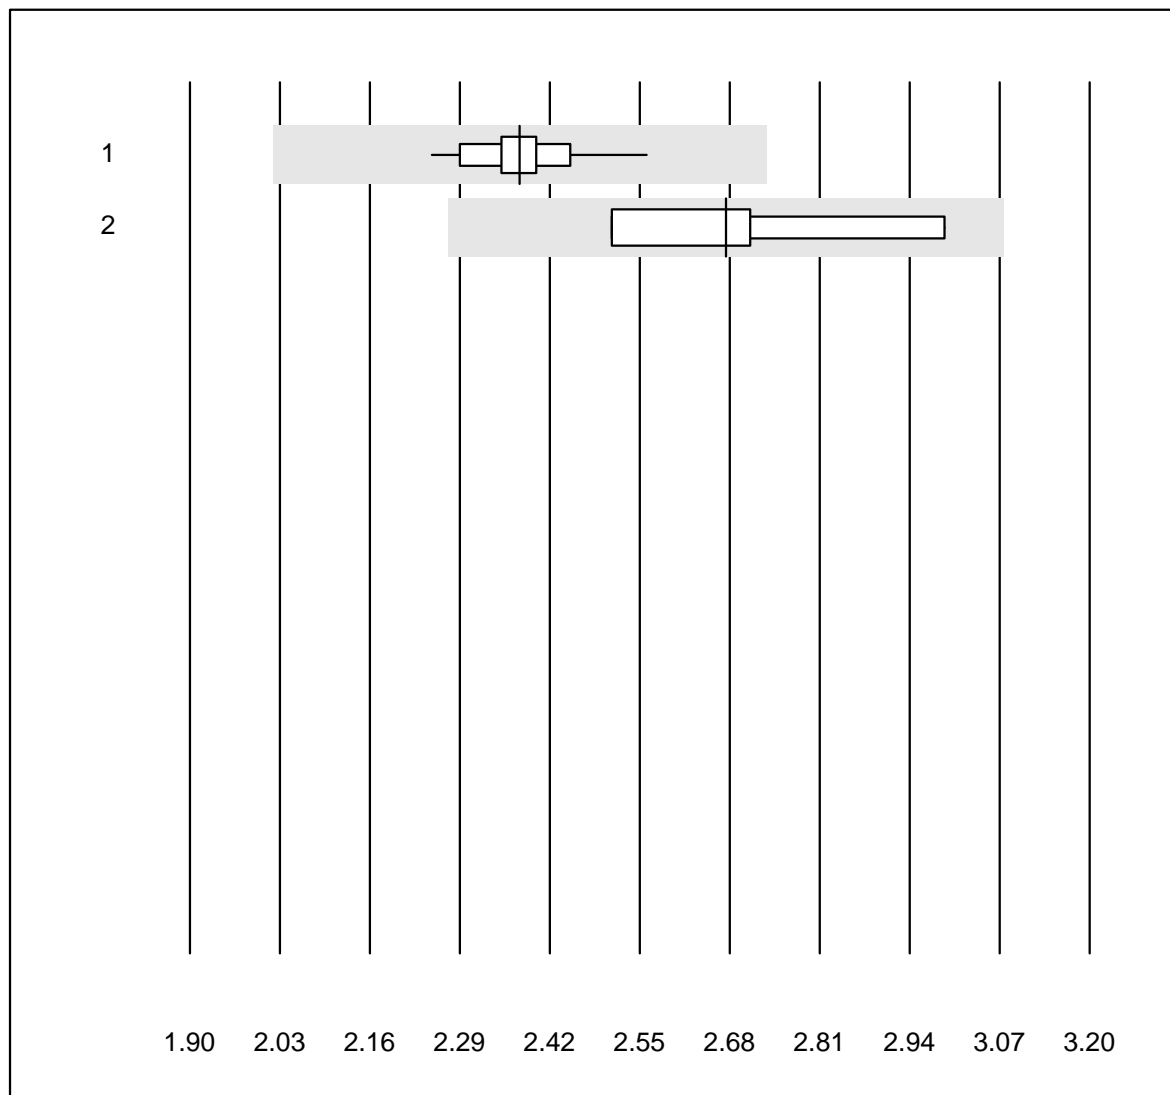


QUALAB Tolérance : 15 %

IgA (g/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Turbidimétrie	18	100.0	0.0	0.0	2.38	2.9	e
2 Néphélométrie	4	100.0	0.0	0.0	2.68	7.5	e*

IgM

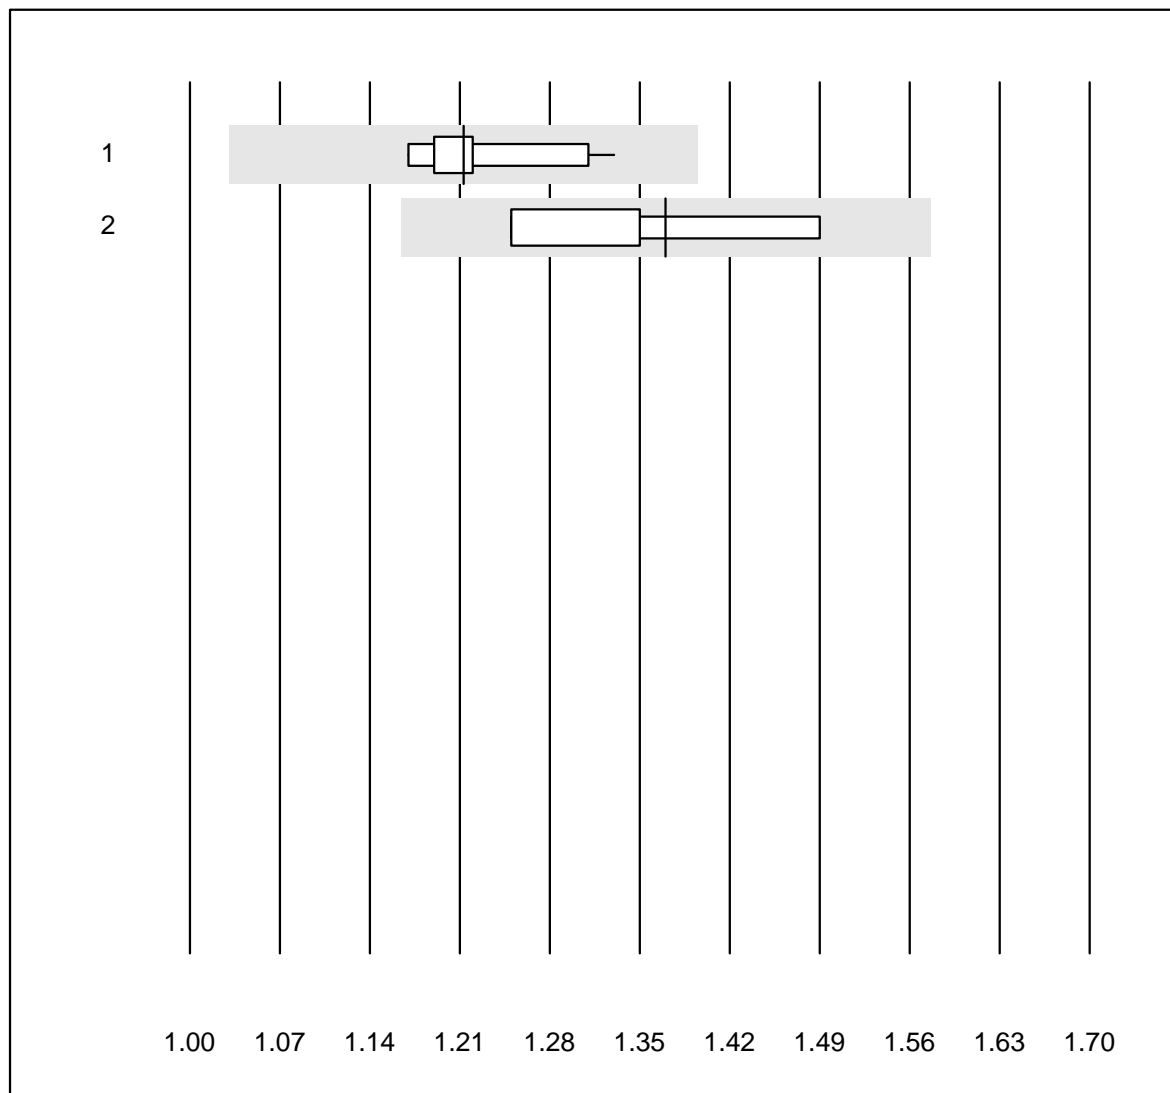


QUALAB Tolérance : 15 %

IgM (g/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Turbidimétrie	18	100.0	0.0	0.0	1.21	3.6	e
2 Néphélométrie	4	100.0	0.0	0.0	1.37	7.8	a

IgE

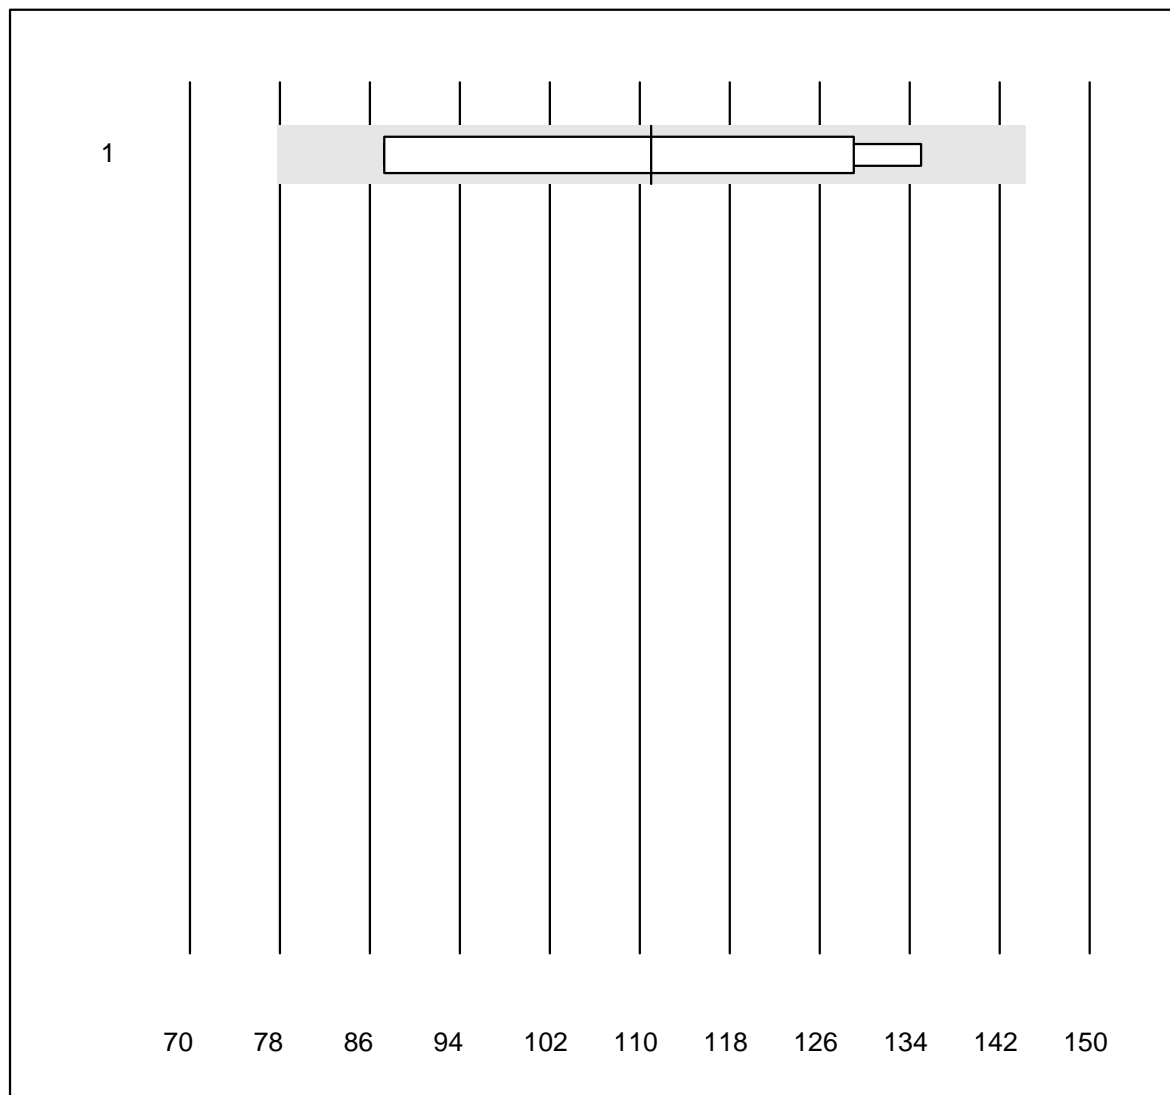


QUALAB Tolérance : 30 %

IgE (kU/L)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	111	18.4	a

Alpha-1-Antitrypsine

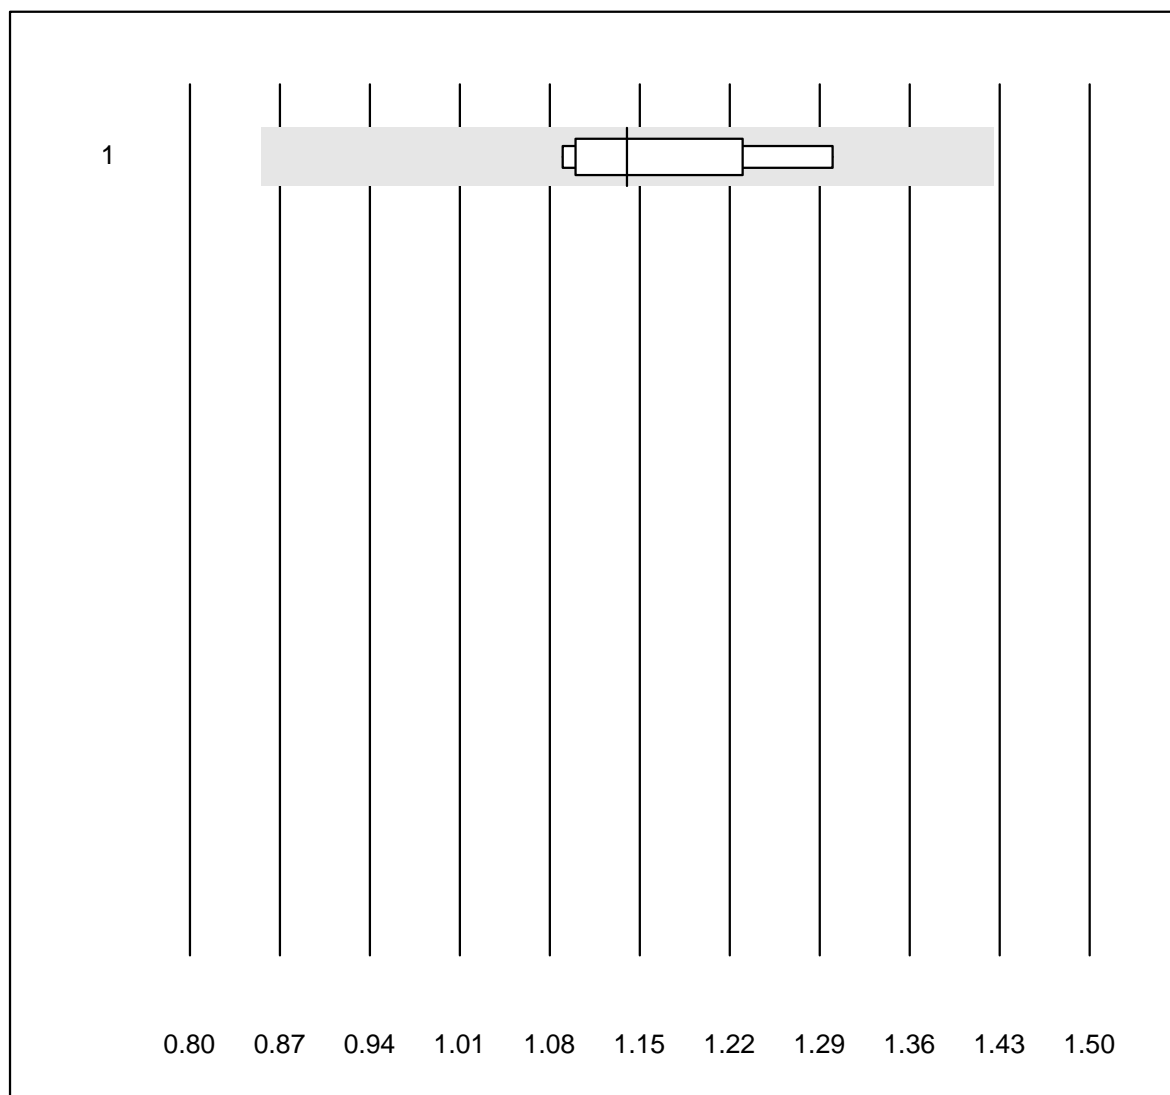


Tolérance MQ : 25 %

Alpha-1-Antitrypsine (g/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	1.14	6.5	e

Anti-Streptolysine-Anticorps

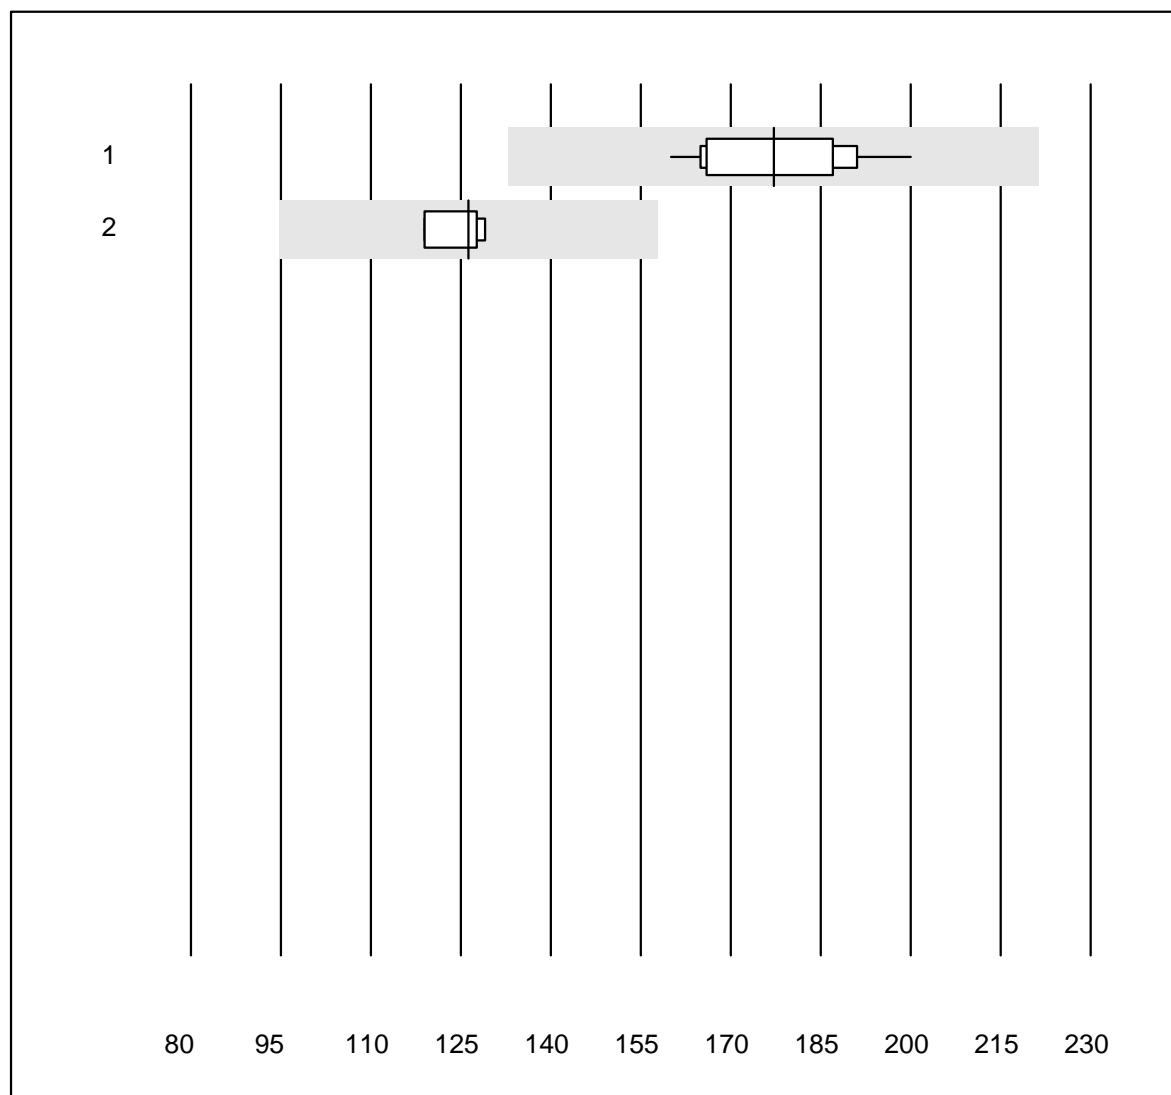


Tolérance MQ : 25 %

Anti-Streptolysine-Anticorps (kIU/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	11	100.0	0.0	0.0	177	6.8	e
2 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	126	3.5	e

Complément C3

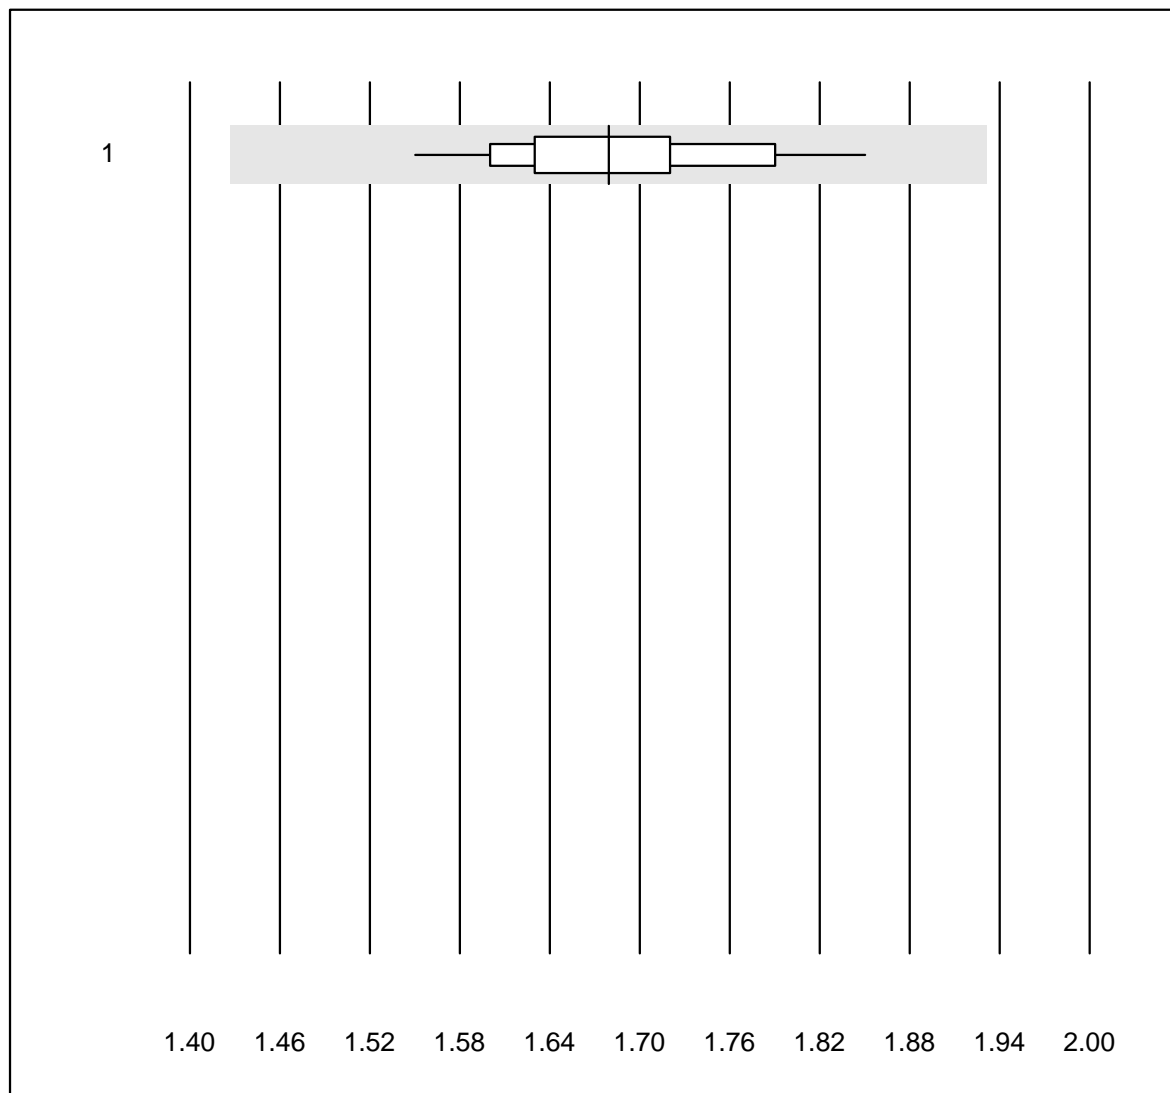


QUALAB Tolérance : 15 %

Complément C3 (g/l)


No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	18	100.0	0.0	0.0	1.68	4.3	e

Complément C4

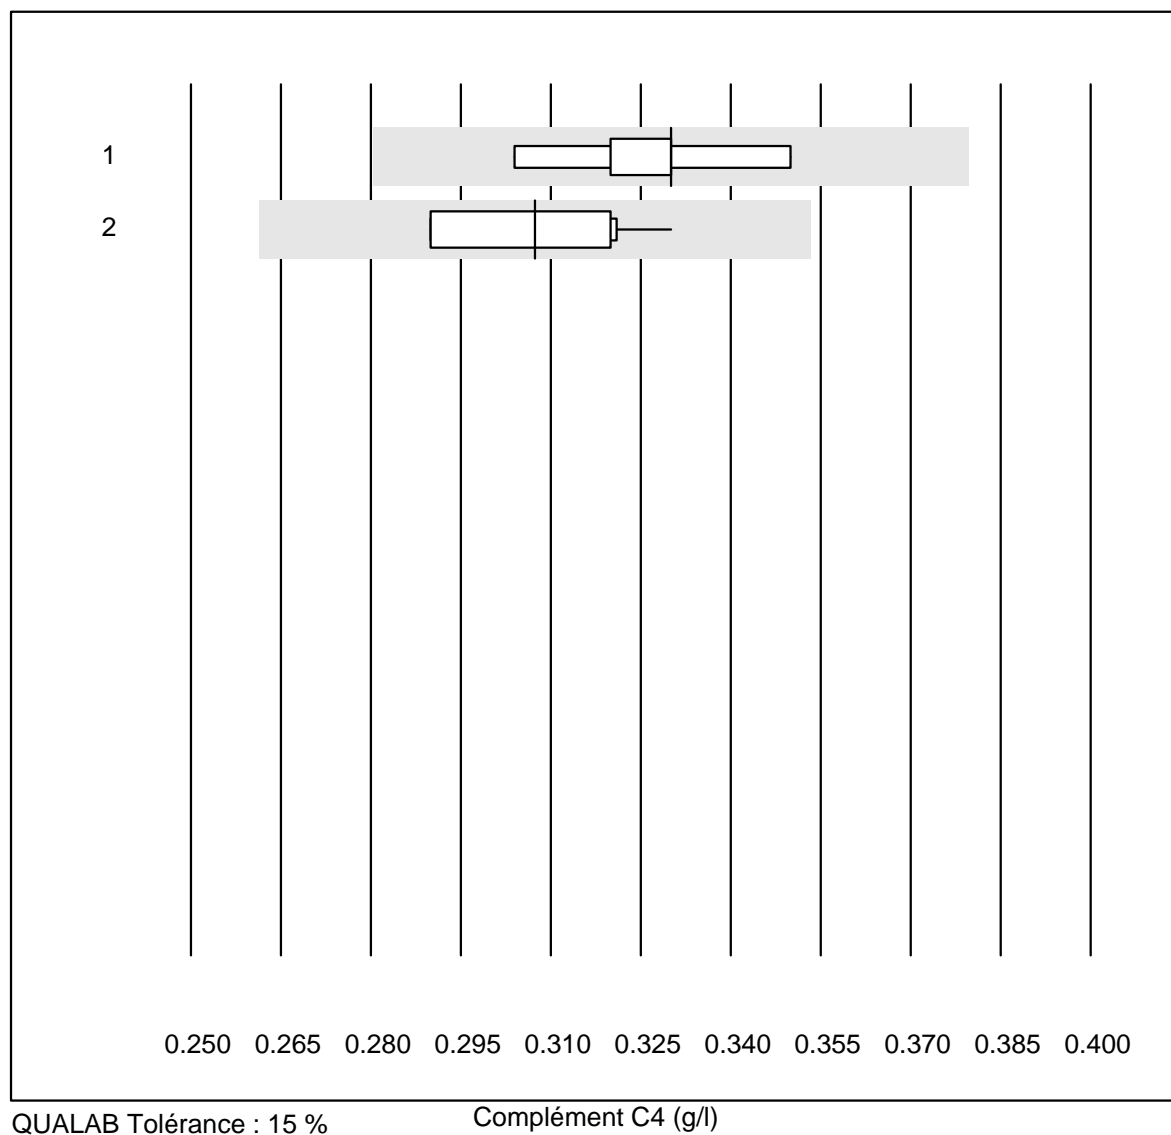


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Alinity	5	100.0	0.0	0.0	0.33	5.1	e*
2 toutes les méthodes	12	100.0	0.0	0.0	0.31	4.6	e

Haptoglobine

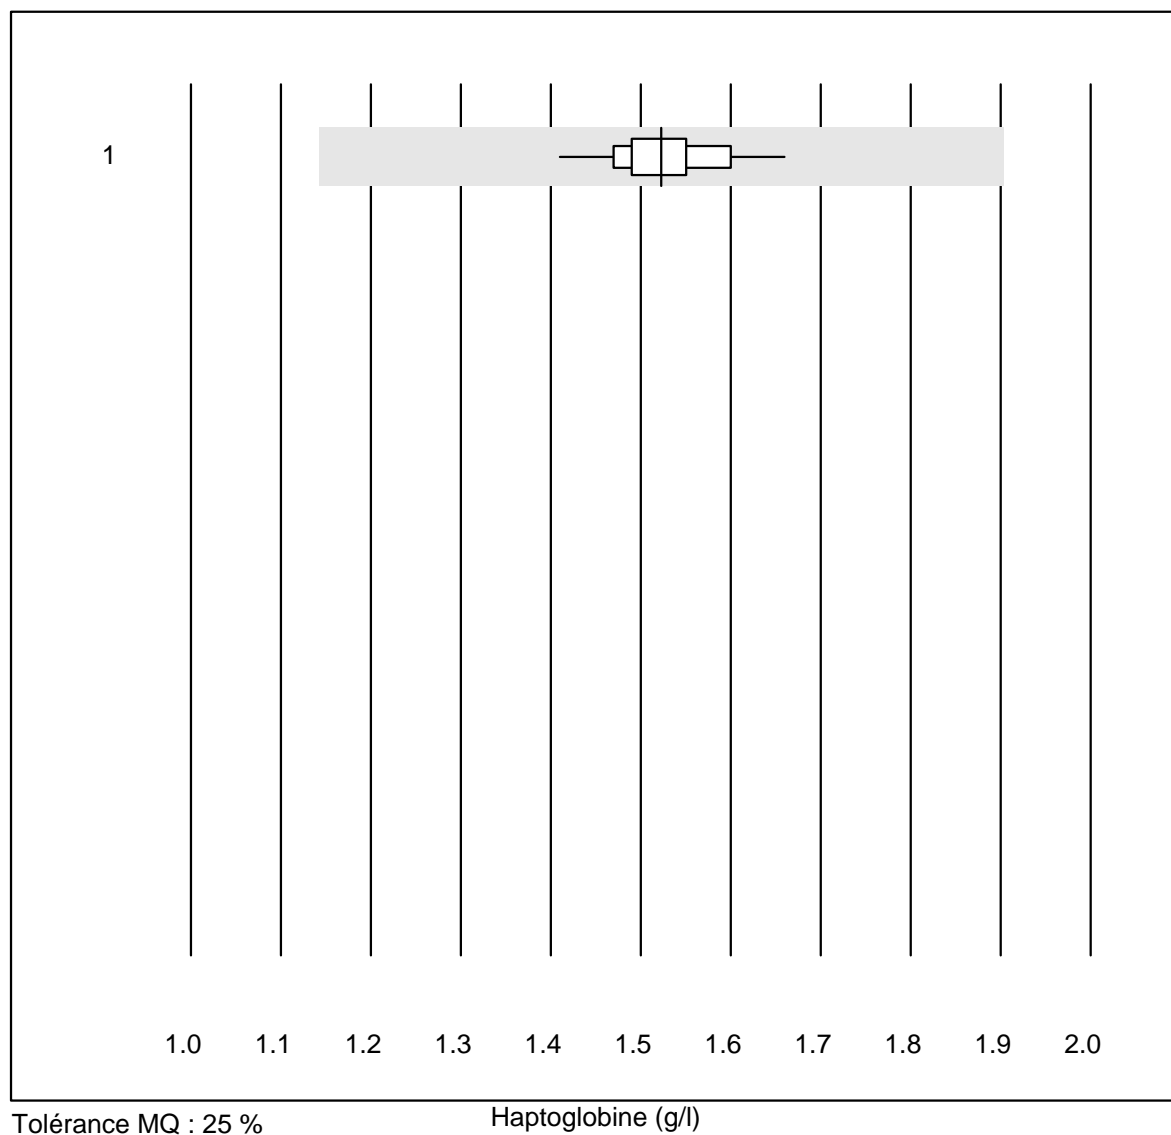


No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	21	100.0	0.0	0.0	1.52	4.0	e

Transferrine

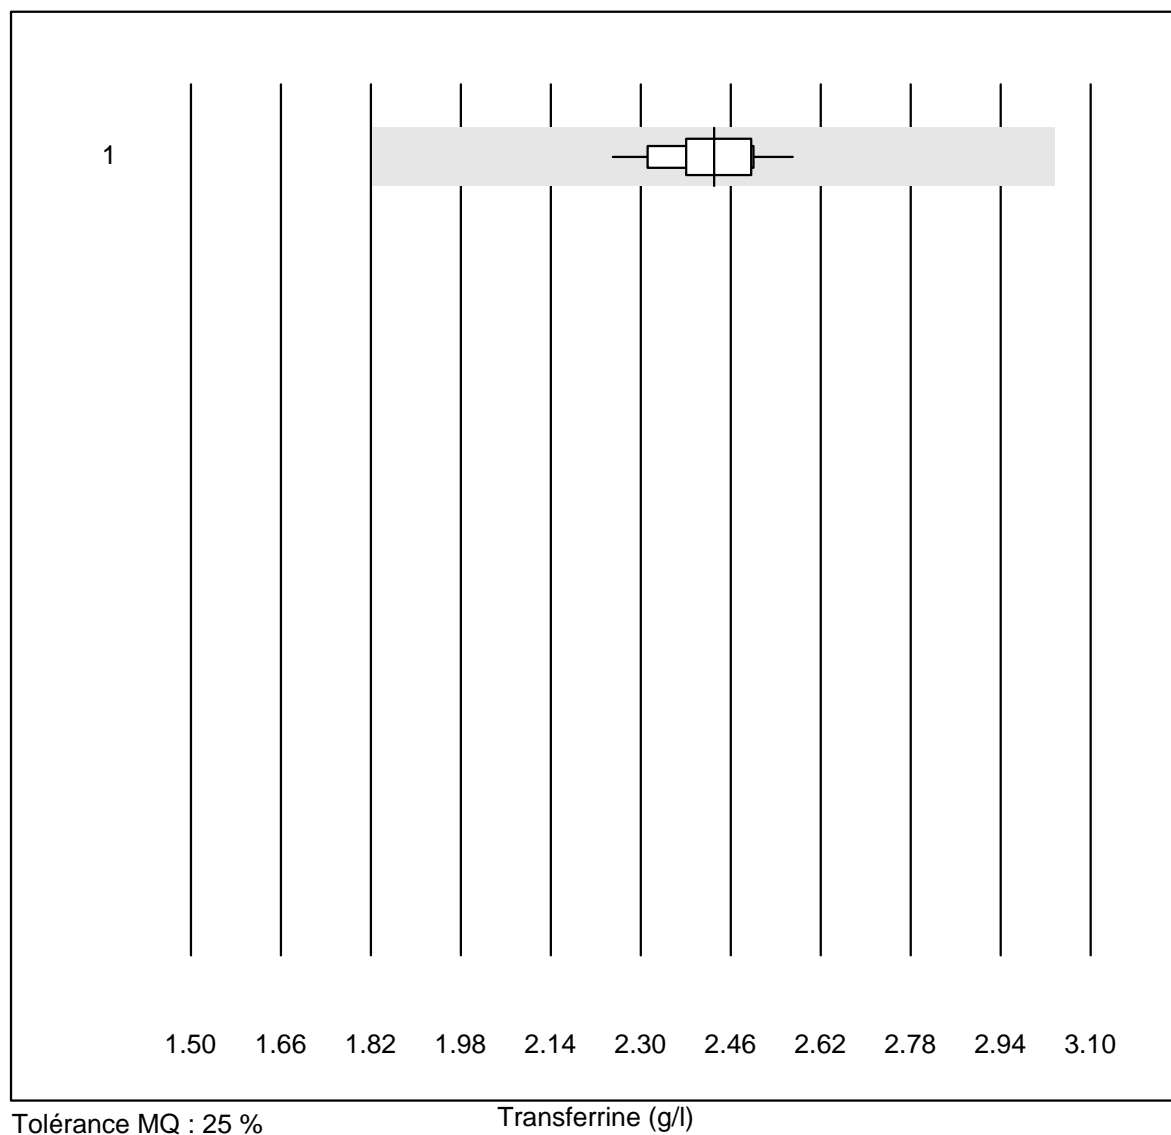


No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	27	100.0	0.0	0.0	2.43	3.1	e

Bêta-2 microglobuline

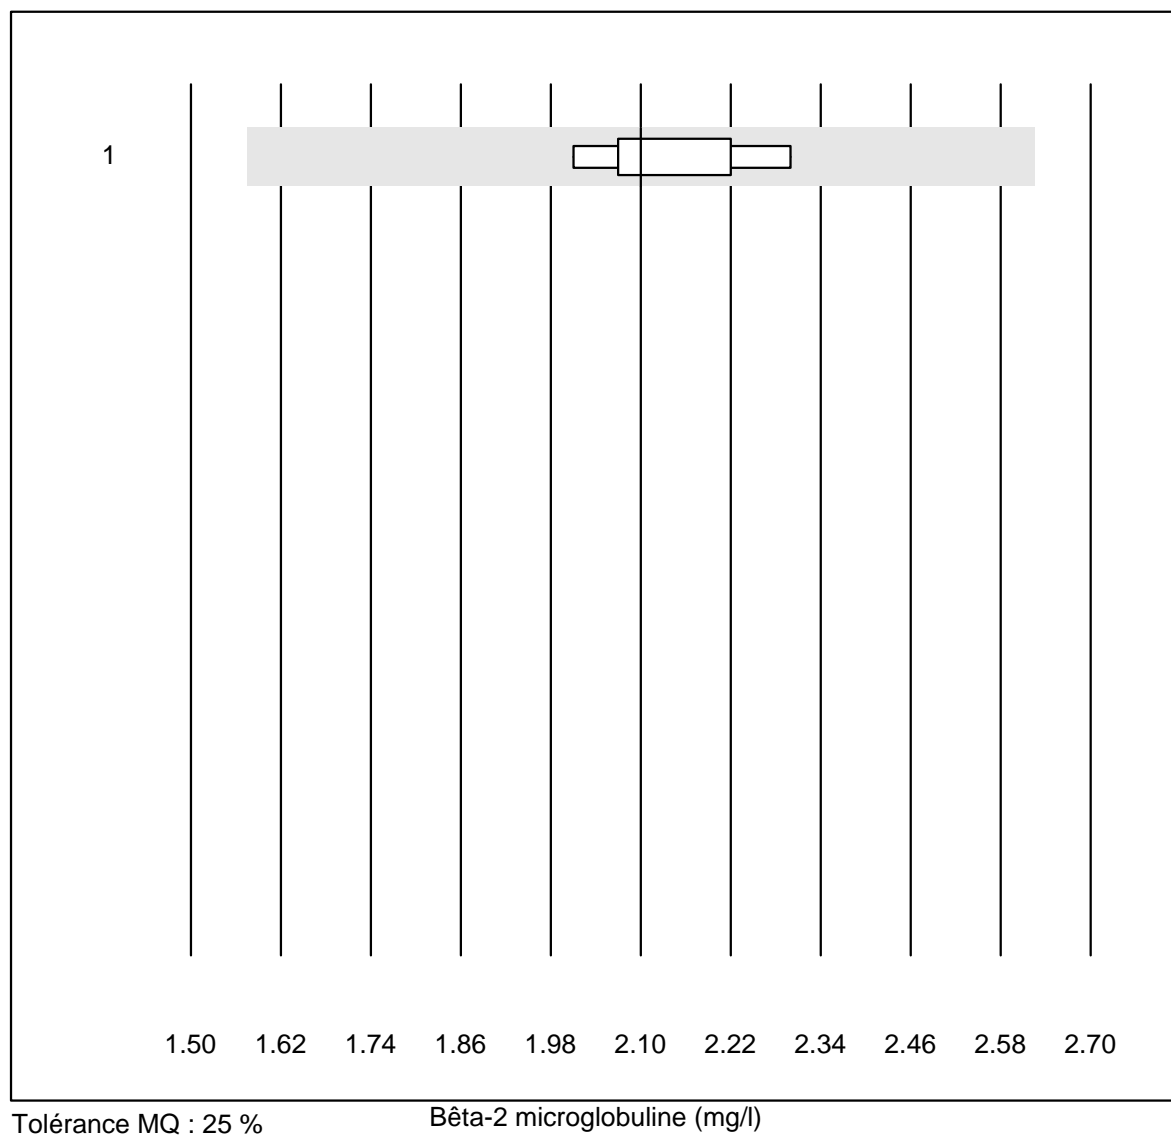

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	2.10	5.0	e

Facteur rhumatoïde

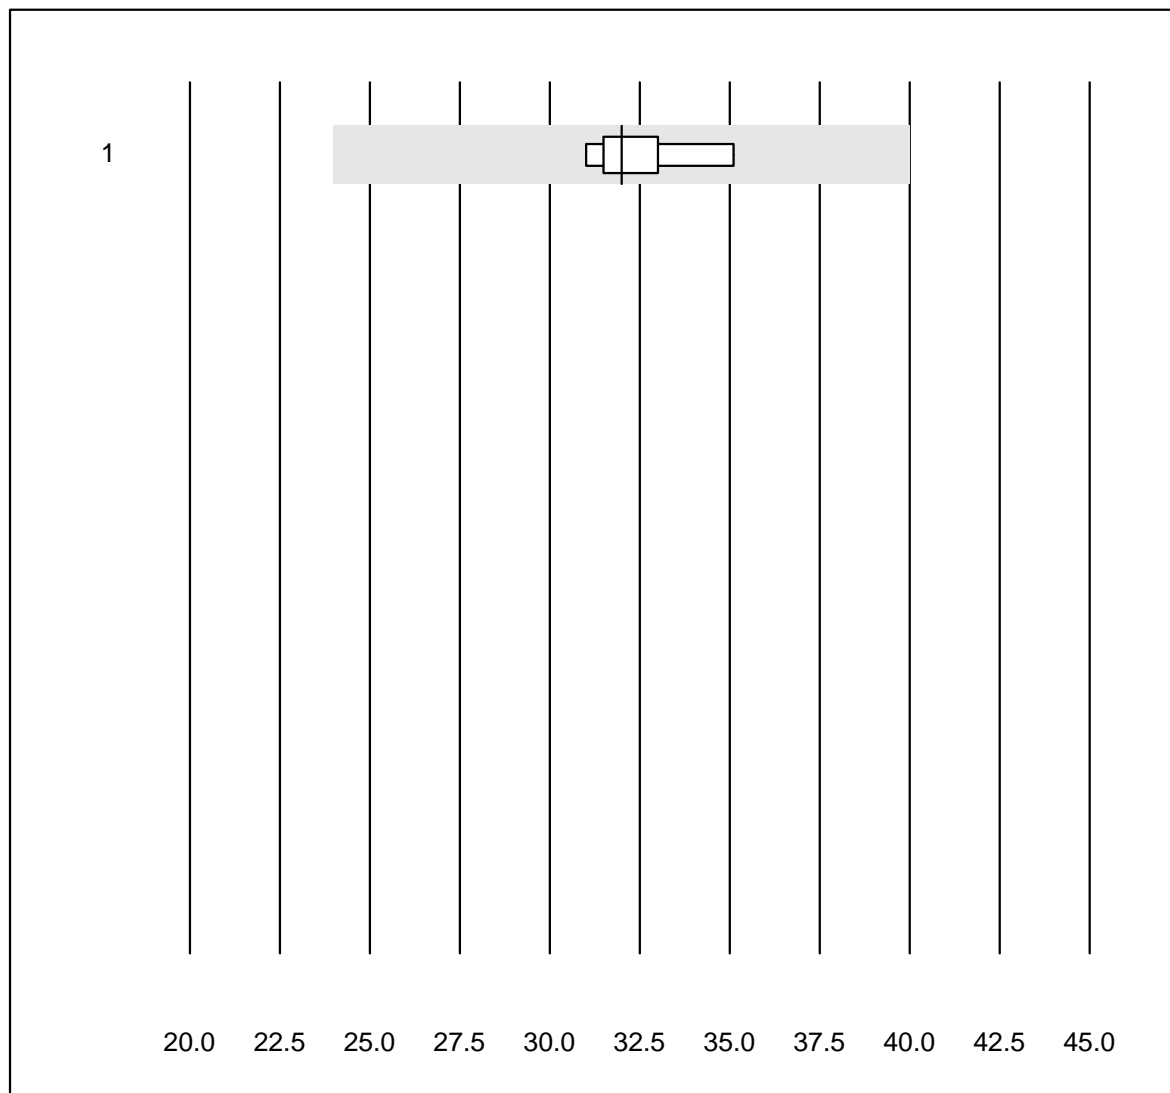


Tolérance MQ : 25 %

Facteur rhumatoïde (U/ml)


No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Architect	5	100.0	0.0	0.0	32.0	5.0	e

Céruleplasmine

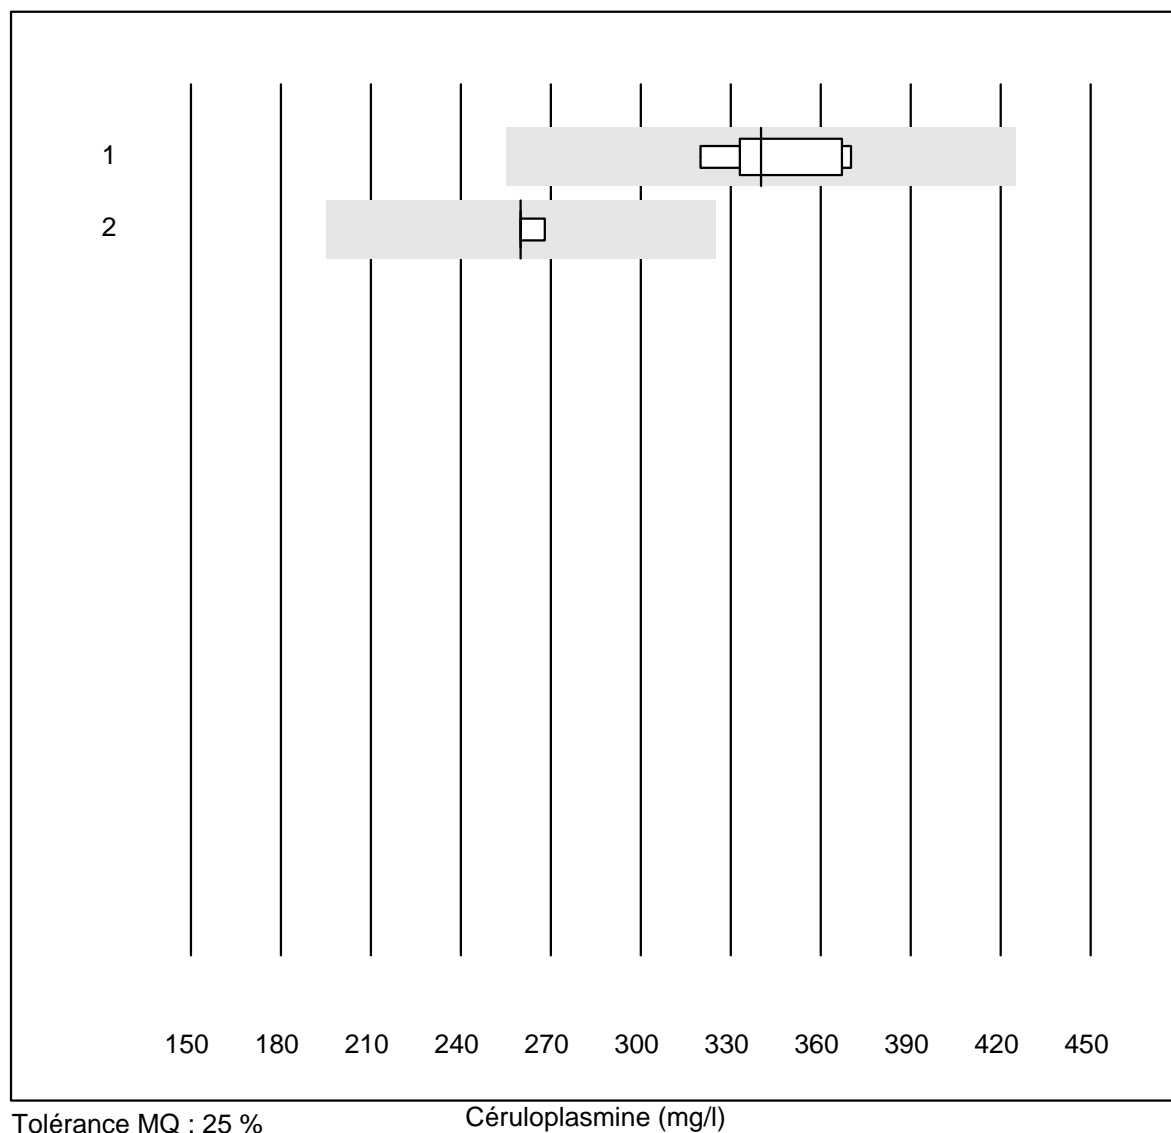

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Siemens	5	100.0	0.0	0.0	340.00	6.3	e
2 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	260.00	1.5	e

Pré-albumine

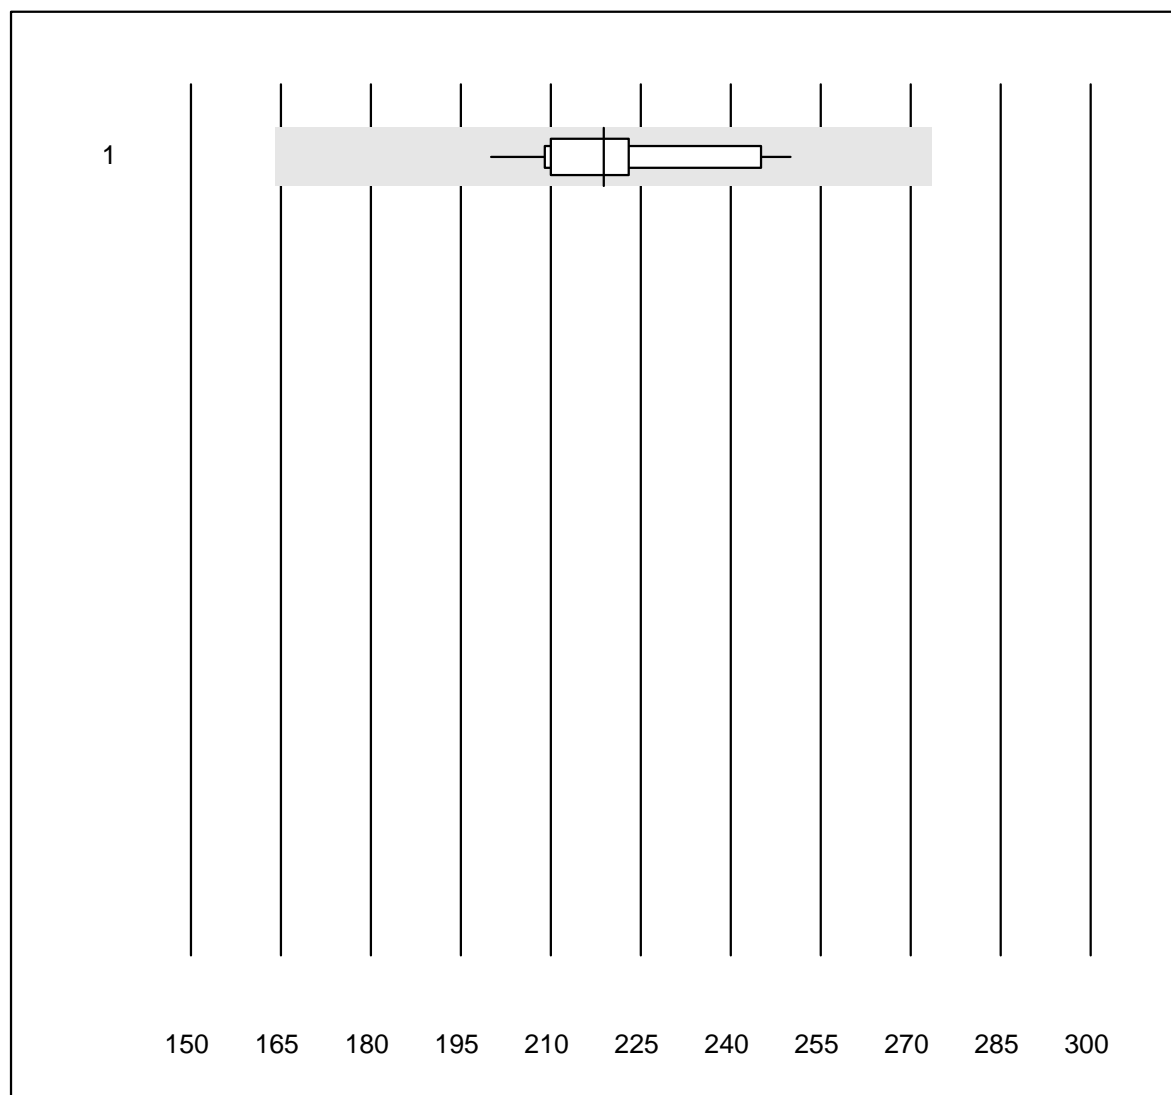


Tolérance MQ : 25 %

Pré-albumine (mg/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	16	100.0	0.0	0.0	218.8	6.1	e

Récepteur soluble de la transferrine

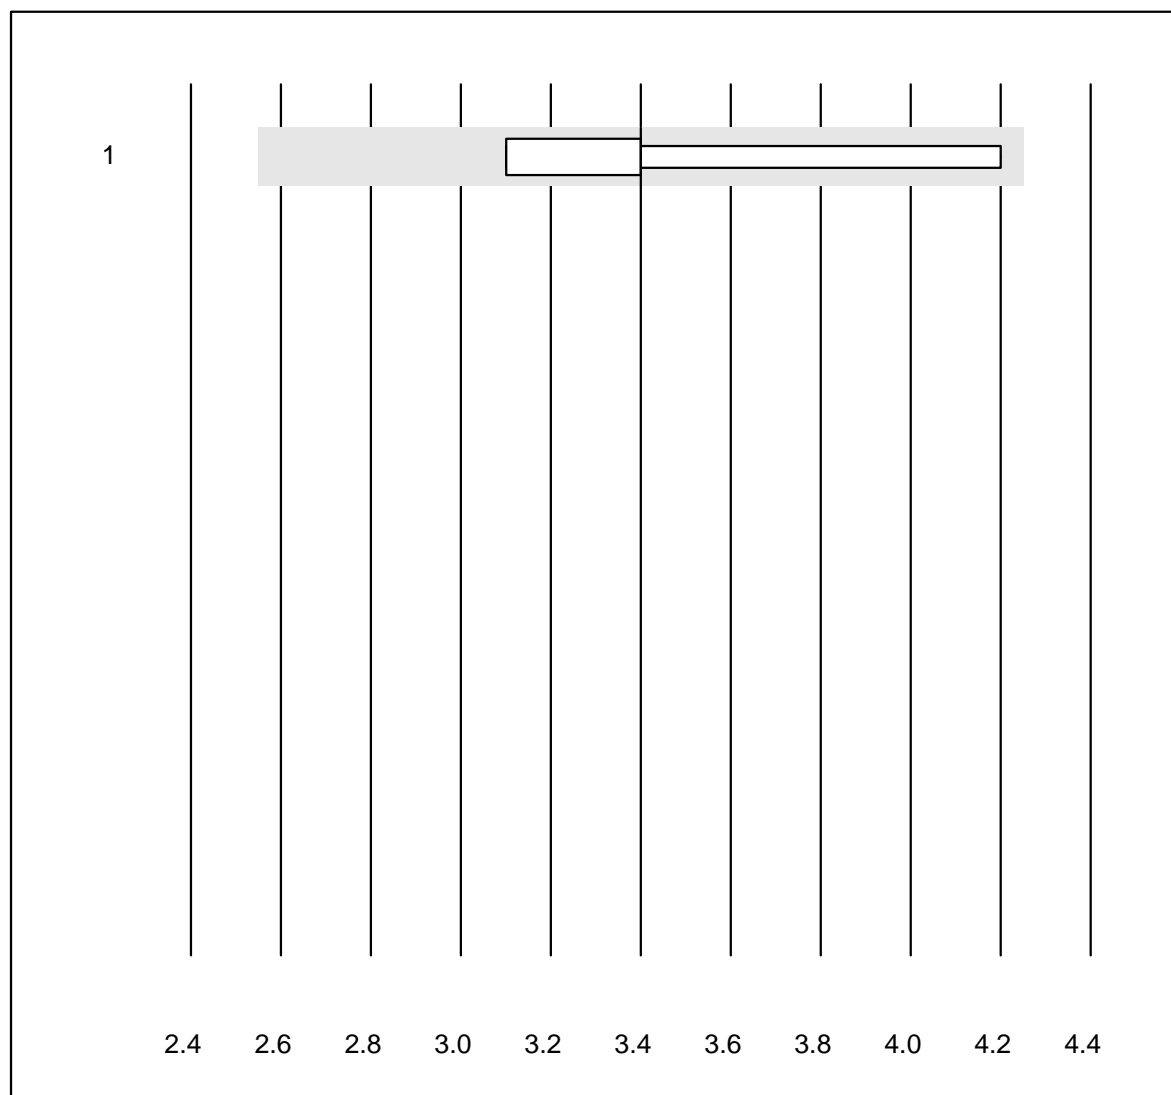


Tolérance MQ : 25 %

Récepteur soluble de la transferrine (mg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	8	100.0	0.0	0.0	3.4	10.8	a


chaînes légères libres Kappa

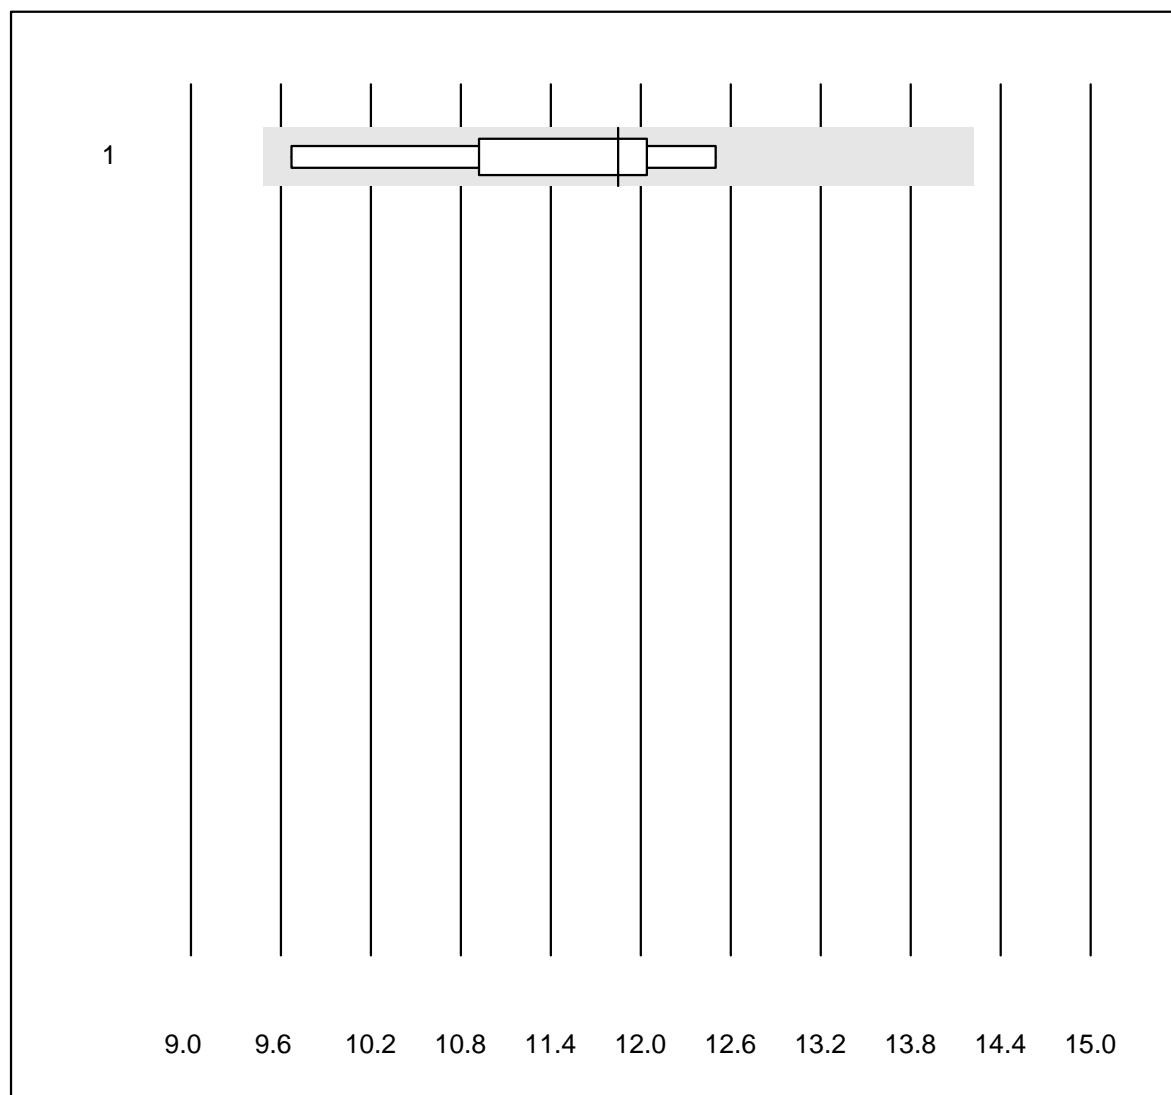

QUALAB Tolérance : 20 % chaînes légères libres Kappa (mg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	8	100.0	0.0	0.0	12	8.0	e*

chaîne légère Lambda

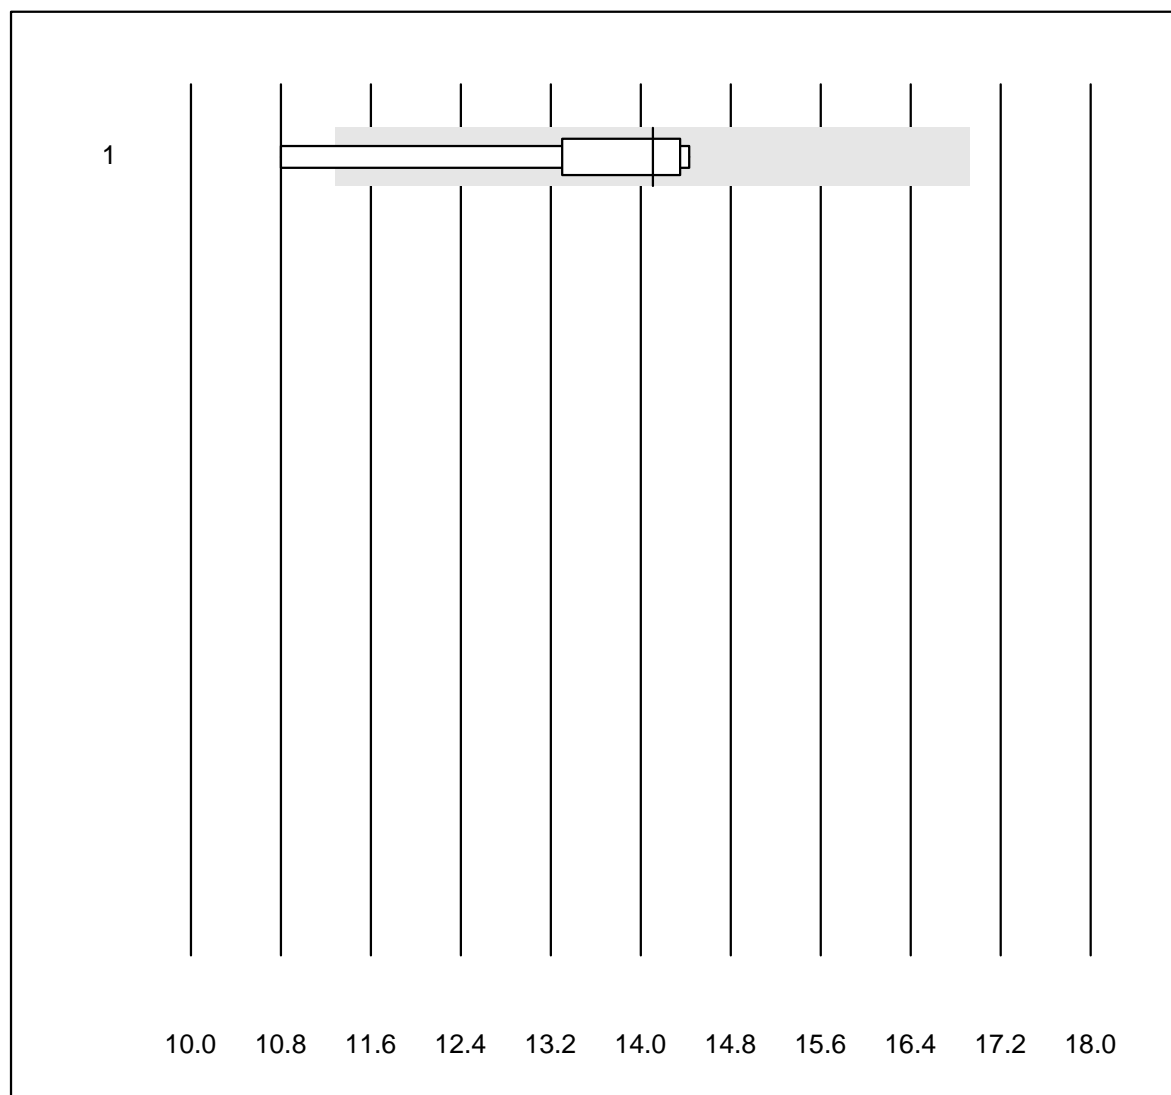


QUALAB Tolérance : 20 %

chaîne légère Lambda (mg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	8	87.5	12.5	0.0	14	9.0	e*

CRP HS

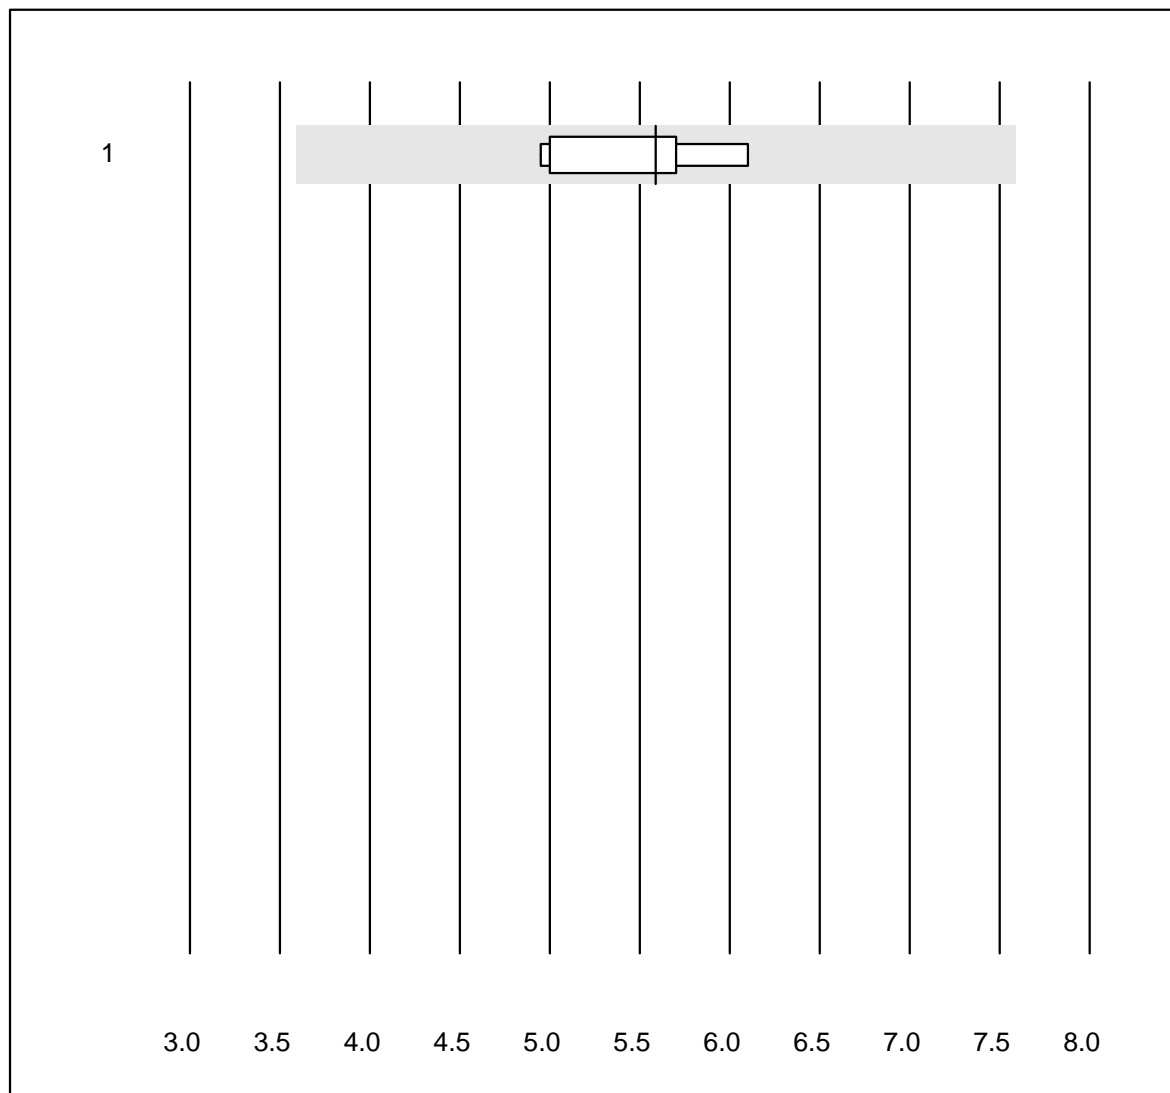


QUALAB Tolérance : 21 %
 (< 10.00: +/- 2.00 mg/l)

CRP HS (mg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Turbidimetrie	7	100.0	0.0	0.0	5.59	7.7	e*

Lipoprotein (a)

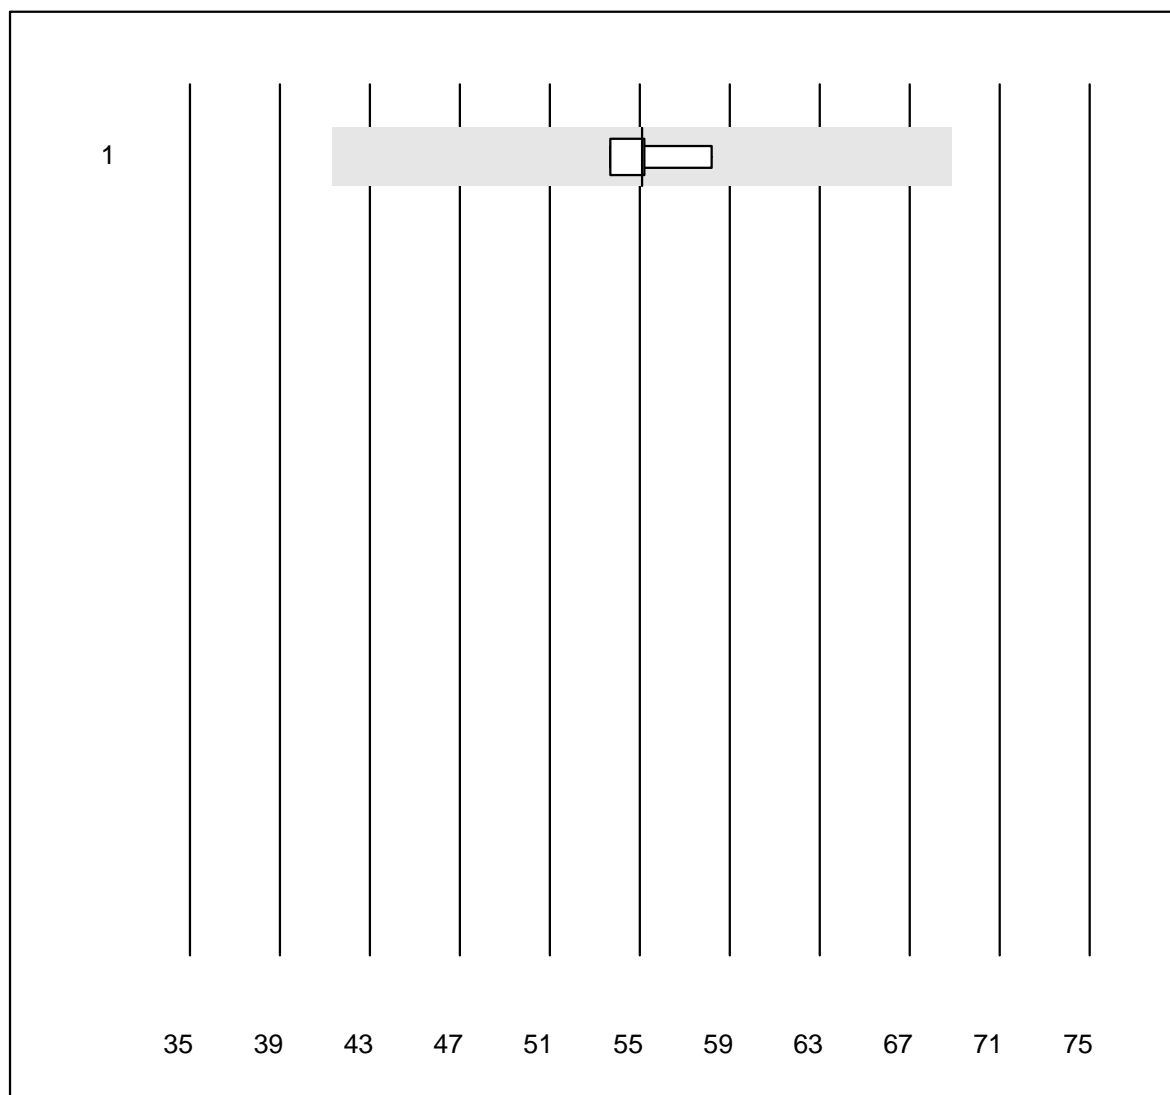


Tolérance MQ : 25 %

Lipoprotein (a) (nmol/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	55	3.4	e

CRP

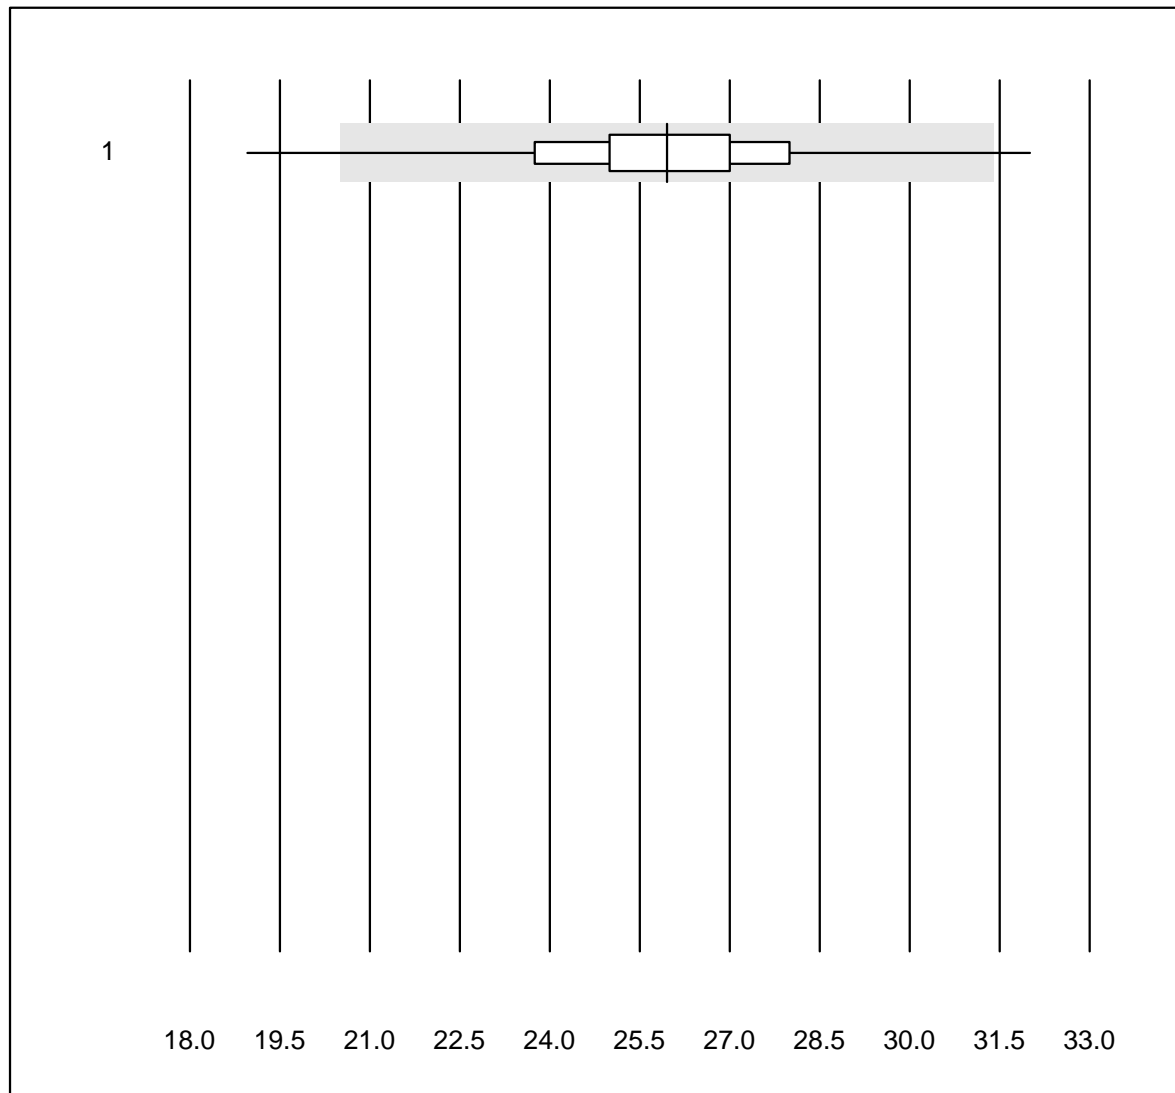


QUALAB Tolérance : 21 %

CRP (mg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 AFIAS	131	87.1	5.3	7.6	26.0	8.5	e

Albumine

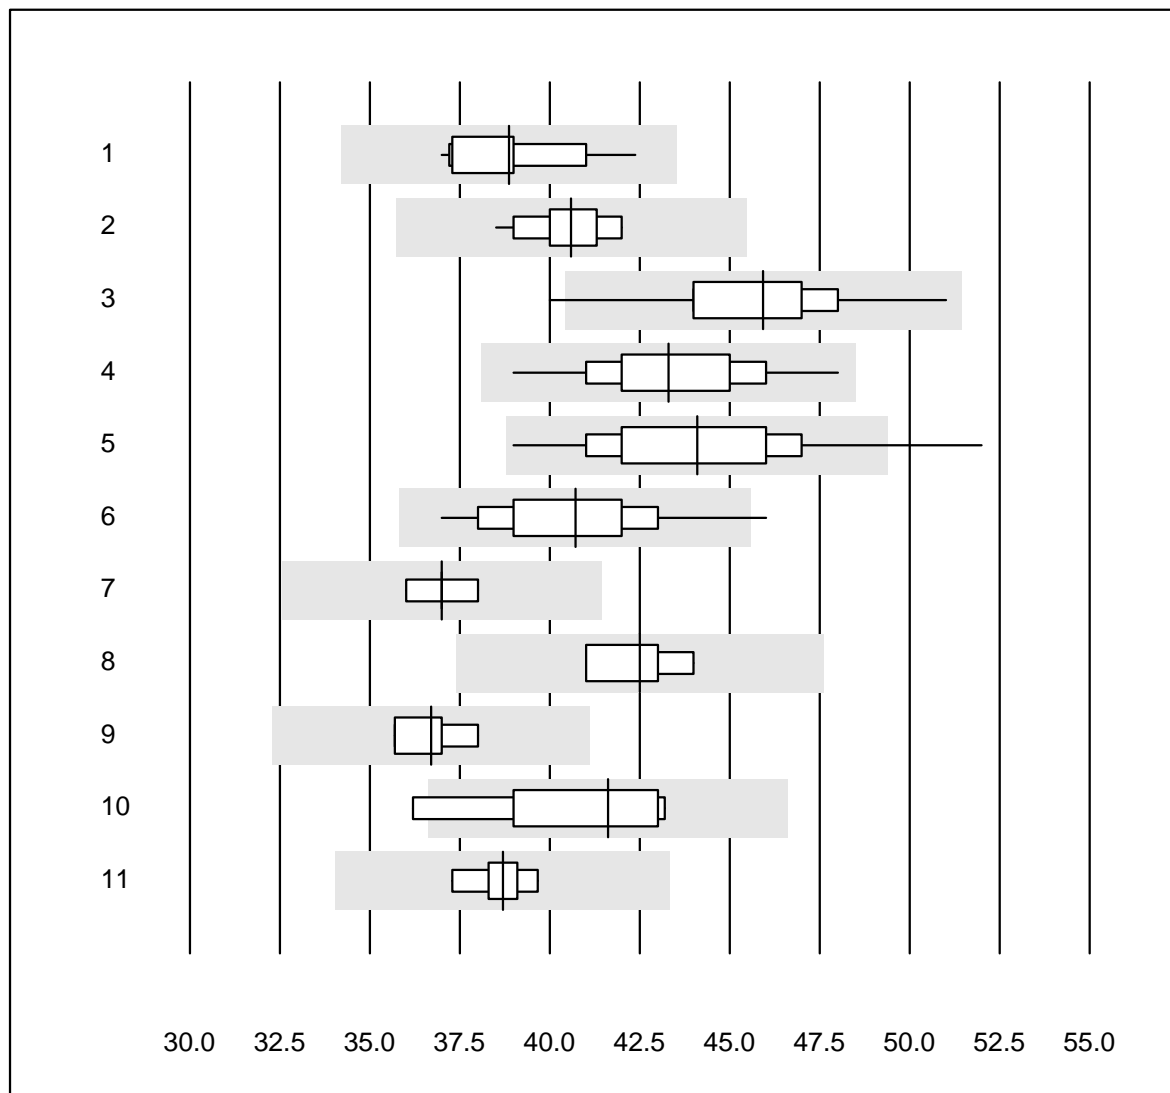


QUALAB Tolérance : 12 %

Albumine (g/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	16	100.0	0.0	0.0	39	4.0	e
2 Cobas	21	100.0	0.0	0.0	41	2.6	e
3 Fuji Dri-Chem	234	99.2	0.4	0.4	46	4.4	e
4 Spotchem SP-4430	24	100.0	0.0	0.0	43	5.4	e
5 Spotchem D-Concept	170	95.8	2.4	1.8	44	5.8	e
6 Piccolo	58	96.6	1.7	1.7	41	4.4	e
7 Beckmann	5	100.0	0.0	0.0	37	1.9	e
8 Skyla	4	100.0	0.0	0.0	43	3.0	e*
9 Dimension	4	100.0	0.0	0.0	37	2.6	e
10 Selectra Pro	8	87.5	12.5	0.0	42	6.1	e*
11 Autolyser/DiaSys	7	100.0	0.0	0.0	39	1.9	e

Phosphatase alcaline

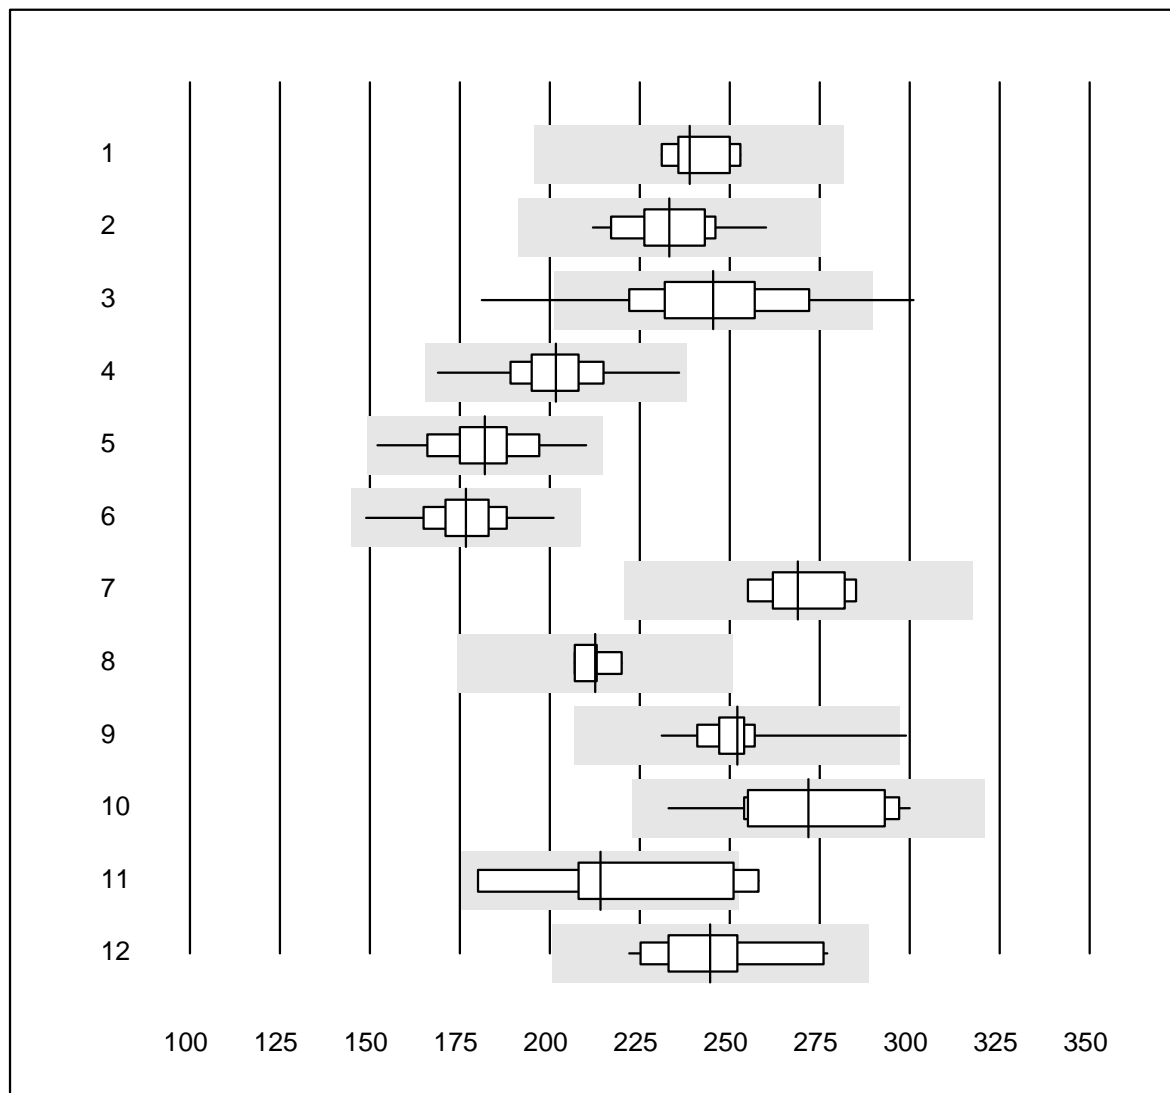


QUALAB Tolérance : 18 %

Phosphatase alcaline (U/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 IFCC	9	100.0	0.0	0.0	239	3.2	e
2 Cobas	22	100.0	0.0	0.0	233	5.0	e
3 Reflotron	399	92.9	5.3	1.8	245	8.4	e
4 Fuji Dri-Chem	863	99.2	0.0	0.8	202	4.9	e
5 Spotchem SP-4430	49	100.0	0.0	0.0	182	6.5	e
6 Spotchem D-Concept	337	99.1	0.0	0.9	177	5.2	e
7 Beckman	7	100.0	0.0	0.0	269	4.1	e
8 Dimension	4	100.0	0.0	0.0	213	2.5	e
9 Piccolo	49	93.9	2.0	4.1	252	3.7	e
10 Selectra Pro	11	100.0	0.0	0.0	272	8.0	e*
11 Skyla	5	80.0	20.0	0.0	214	14.5	e*
12 Autolyser/DiaSys	19	100.0	0.0	0.0	245	6.3	e
13 Autres méthodes	5	100.0	0.0	0.0	231	4.8	e

Amylase

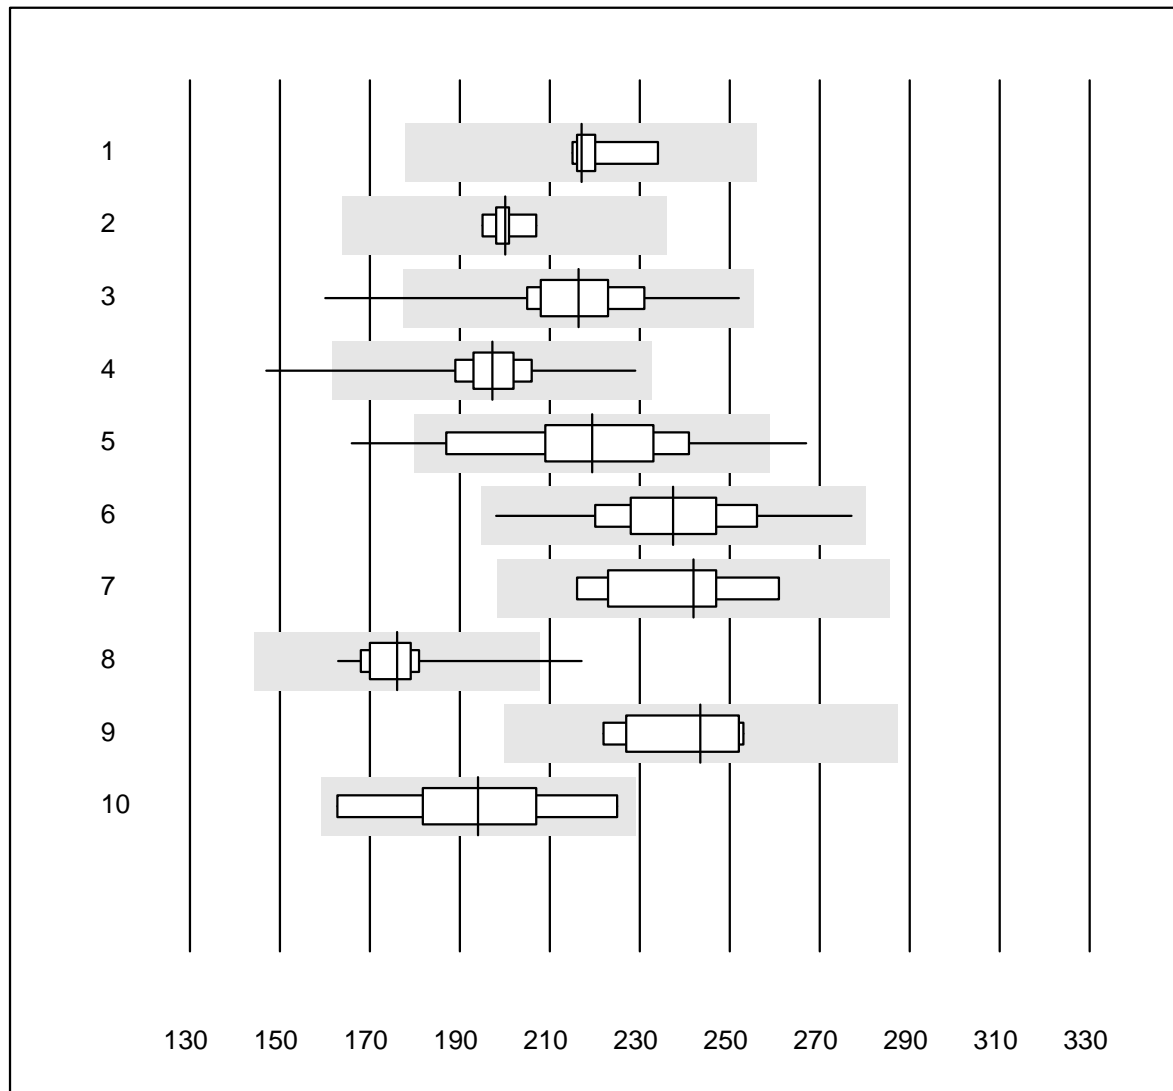


QUALAB Tolérance : 18 %

Amylase (U/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 IFCC	6	100.0	0.0	0.0	217	3.2	e
2 Cobas	9	100.0	0.0	0.0	200	1.8	e
3 Reflotron	100	99.0	1.0	0.0	216	5.4	e
4 Fuji Dri-Chem	628	99.2	0.5	0.3	197	4.0	e
5 Spotchem SP-4430	41	92.7	7.3	0.0	219	9.5	e
6 Spotchem D-Concept	261	100.0	0.0	0.0	237	5.8	e
7 Architect	5	100.0	0.0	0.0	242	7.7	e*
8 Piccolo	50	98.0	2.0	0.0	176	4.5	e
9 Selectra Pro	6	100.0	0.0	0.0	244	5.6	e*
10 Autolyser/DiaSys	7	100.0	0.0	0.0	194	10.1	e*

Amylase pancréatique

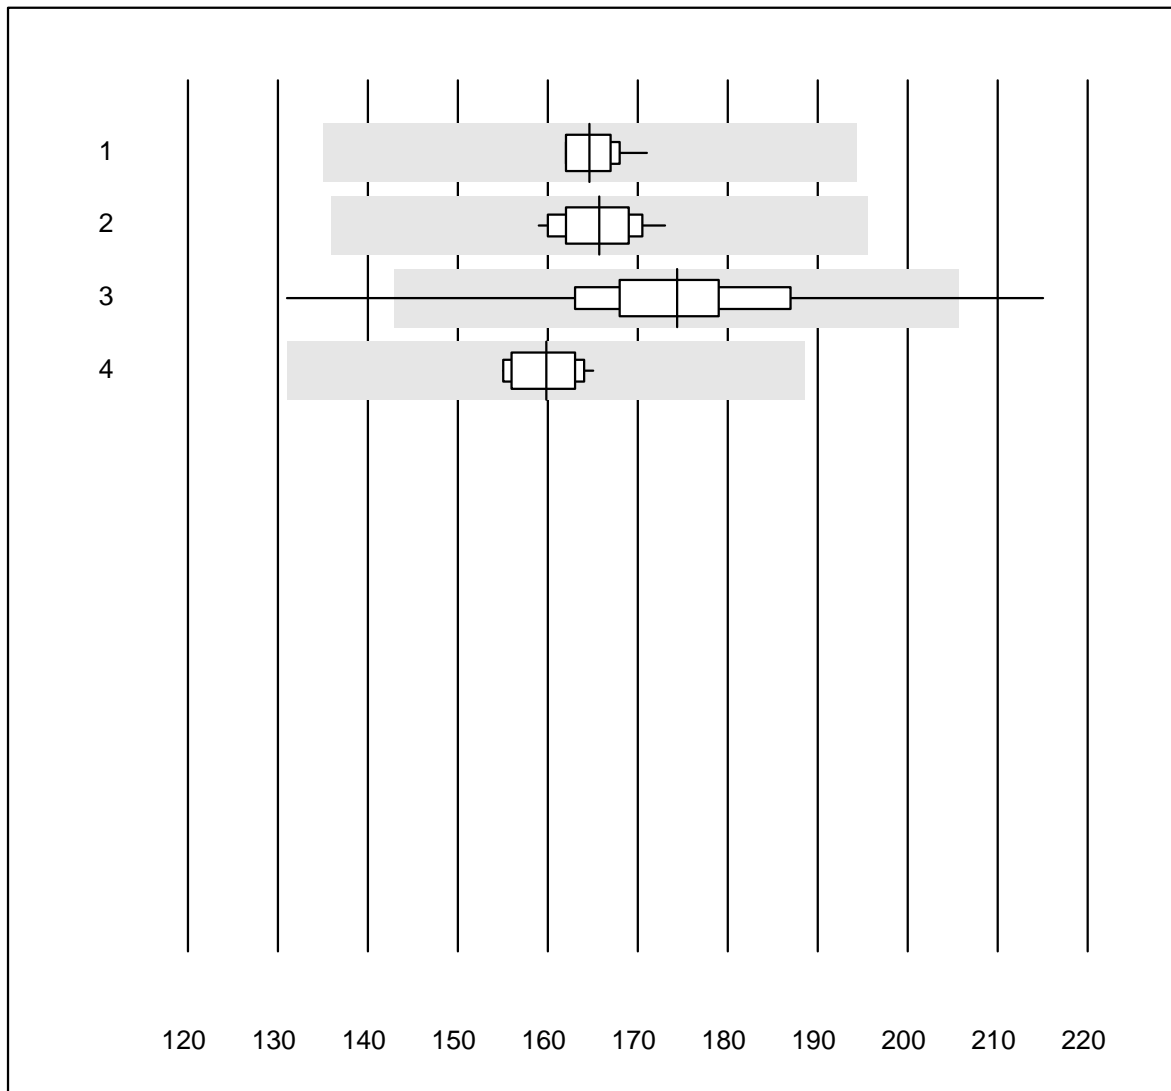


QUALAB Tolérance : 18 %

Amylase pancréatique (U/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 IFCC	11	100.0	0.0	0.0	165	1.7	e
2 Cobas	13	100.0	0.0	0.0	166	2.6	e
3 Reflotron	281	97.9	2.1	0.0	174	6.1	e
4 Autolyser/DiaSys	10	100.0	0.0	0.0	160	2.2	e

Bilirubine totale

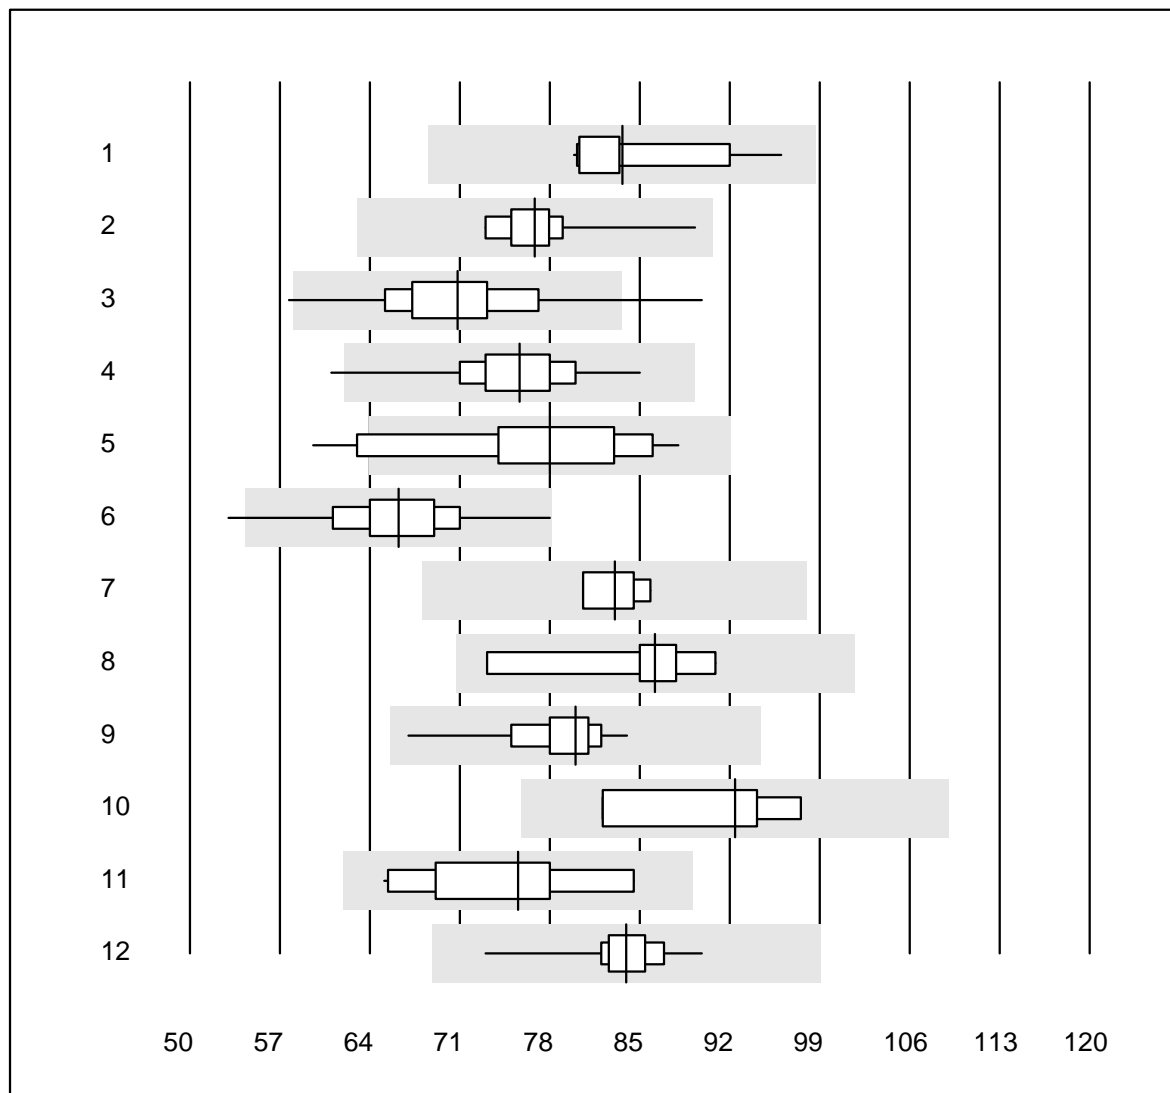


QUALAB Tolérance : 18 %

Bilirubine totale (µmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	Chimie humide	16	100.0	0.0	0.0	83.6	5.3	e
2	Cobas	20	100.0	0.0	0.0	76.8	4.6	e
3	Reflotron	304	95.1	2.3	2.6	70.8	7.1	e
4	Fuji Dri-Chem	698	98.6	0.3	1.1	75.7	4.7	e
5	Spotchem SP-4430	50	88.0	10.0	2.0	78.0	10.2	e
6	Spotchem D-Concept	272	98.5	0.4	1.1	66.2	5.6	e
7	Dimension	4	100.0	0.0	0.0	83.1	2.9	e
8	Beckman	6	100.0	0.0	0.0	86.2	7.2	e*
9	Piccolo	58	98.3	0.0	1.7	80.0	3.7	e
10	Skylla	4	100.0	0.0	0.0	92.4	7.3	e*
11	Selectra Pro	12	100.0	0.0	0.0	75.5	8.6	e*
12	Autolyser/DiaSys	16	100.0	0.0	0.0	84.0	4.3	e

Bilirubine directe

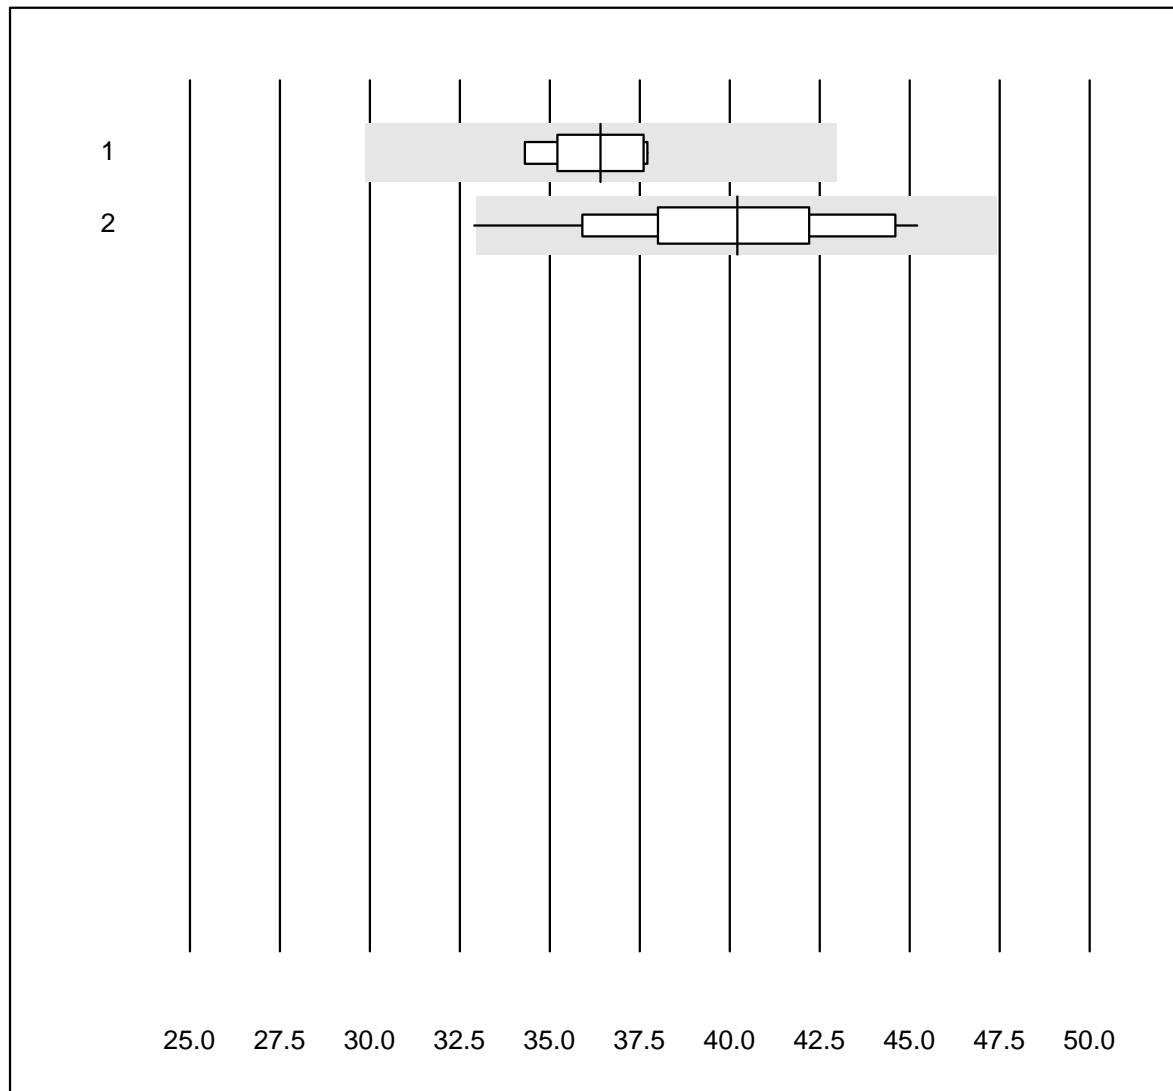


Tolérance MQ : 18 %

Bilirubine directe (µmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Autolyser/DiaSys	6	100.0	0.0	0.0	36.4	3.8	e
2 Fuji Dri-Chem	32	96.9	3.1	0.0	40.2	7.6	e

Calcium

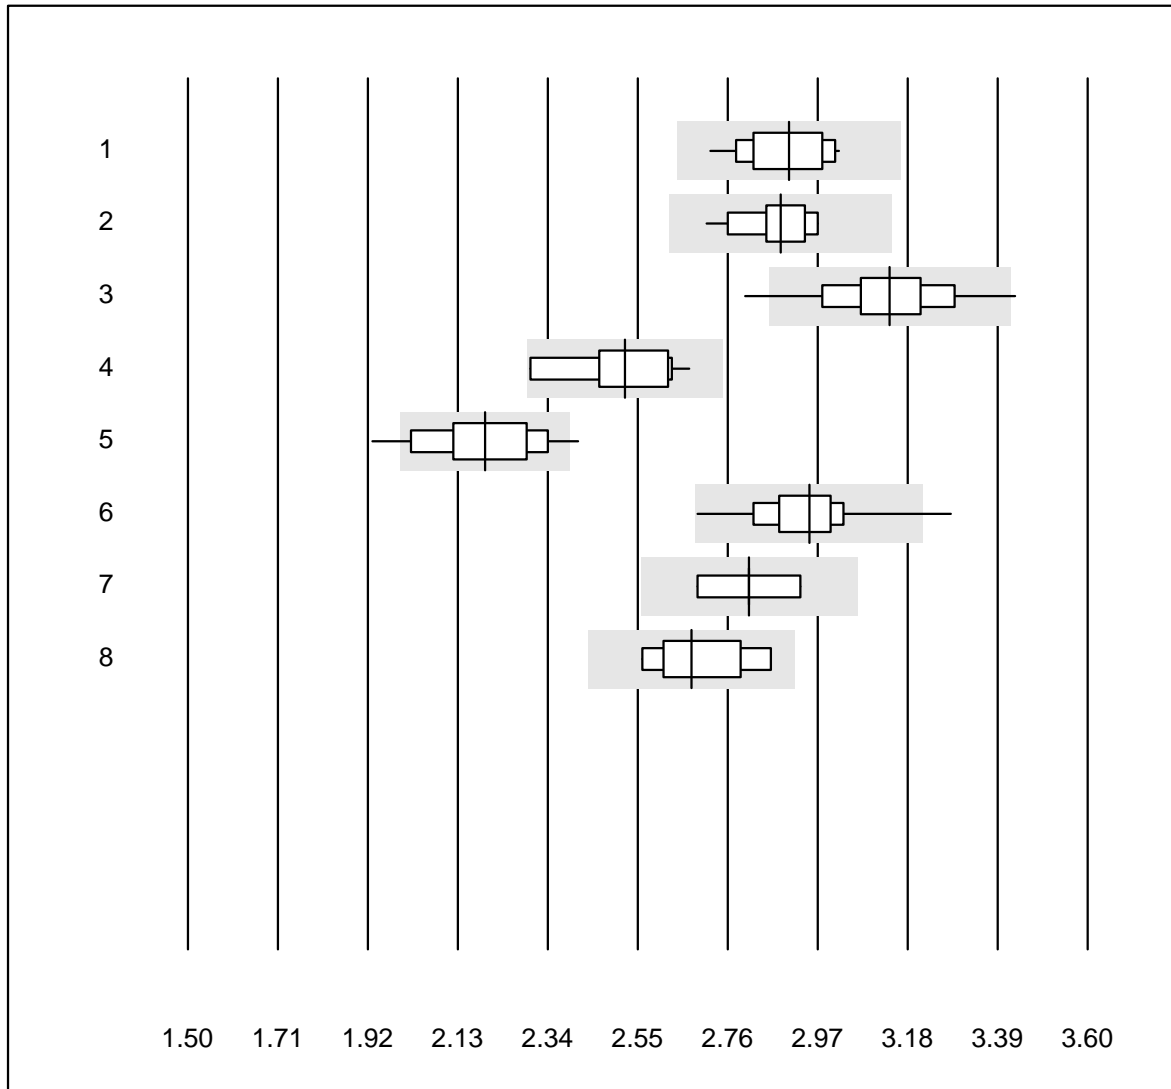


QUALAB Tolérance : 9 %

Calcium (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	25	100.0	0.0	0.0	2.90	3.1	e
2 Cobas	22	100.0	0.0	0.0	2.88	2.6	e
3 Fuji Dri-Chem	347	97.7	0.9	1.4	3.14	3.6	e
4 Spotchem SP-4430	12	83.3	0.0	16.7	2.52	4.3	e*
5 Spotchem D-Concept	75	81.4	9.3	9.3	2.19	5.3	e
6 Piccolo	52	98.1	1.9	0.0	2.95	3.5	e
7 Selectra Pro	5	100.0	0.0	0.0	2.81	3.0	e*
8 Autolyser/DiaSys	8	100.0	0.0	0.0	2.68	3.9	e*

Calcium ISE

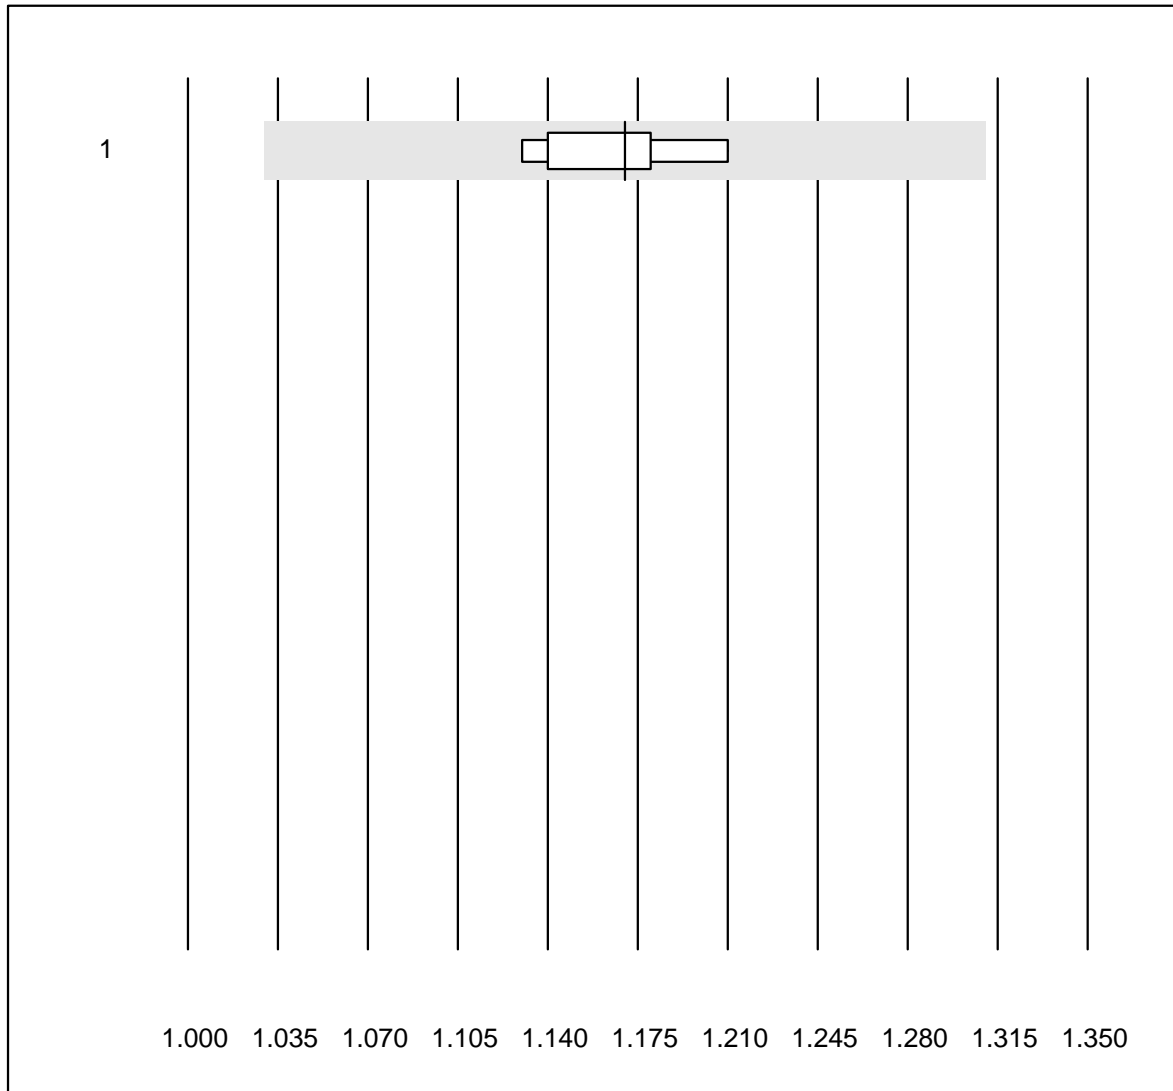


Tolérance MQ : 12 %

Calcium ISE (mmol/l)


No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 iStat Chem8	5	100.0	0.0	0.0	1.17	2.8	e

Chlorures

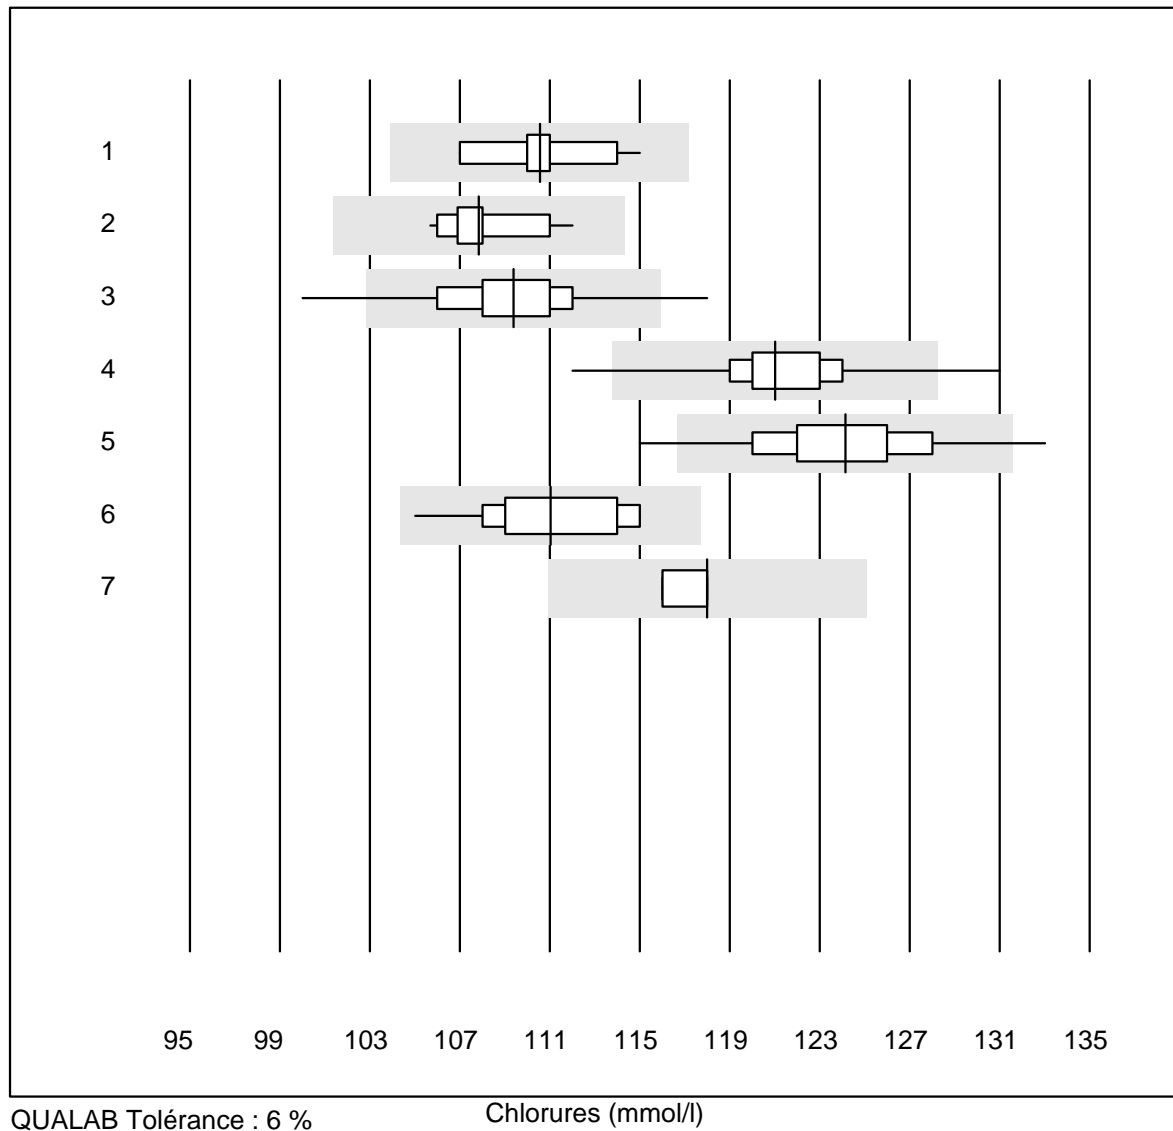

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 ISE	26	100.0	0.0	0.0	111	1.9	e
2 Cobas	13	100.0	0.0	0.0	108	1.7	e
3 Fuji Dri-Chem	784	97.4	1.7	0.9	109	2.1	e
4 Spotchem D-Concept	306	96.7	2.0	1.3	121	2.2	e
5 Spotchem EL-SE 1520	55	87.3	3.6	9.1	124	2.9	e
6 Piccolo	23	100.0	0.0	0.0	111	2.7	e
7 iStat Chem8	5	100.0	0.0	0.0	118	0.9	e

Cholestérol

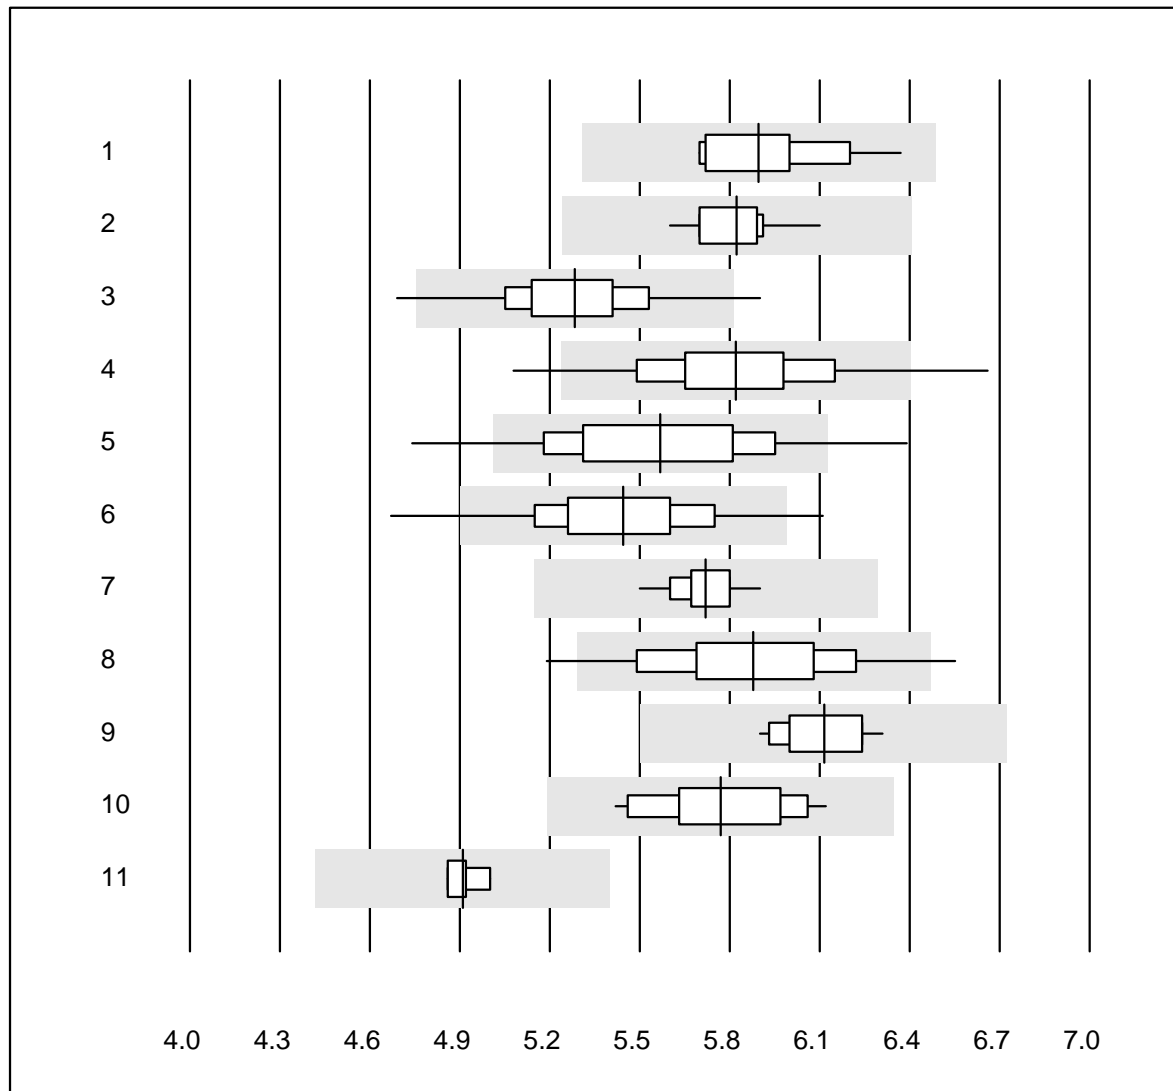


QUALAB Tolérance : 10 %

Cholestérol (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	23	100.0	0.0	0.0	5.90	3.5	e
2 Cobas	20	100.0	0.0	0.0	5.82	2.0	e
3 Reflotron	318	95.9	2.2	1.9	5.28	3.9	e
4 Fuji Dri-Chem	836	96.4	2.3	1.3	5.82	4.4	e
5 Spotchem SP-4430	71	91.6	5.6	2.8	5.57	5.5	e
6 Spotchem D-Concept	339	96.7	1.8	1.5	5.45	4.5	e
7 Piccolo	20	100.0	0.0	0.0	5.72	1.7	e
8 Cholestech LDX	309	93.9	2.9	3.2	5.88	4.7	e
9 Selectra Pro	11	100.0	0.0	0.0	6.11	2.3	e
10 Autolyser/DiaSys	19	100.0	0.0	0.0	5.77	3.5	e
11 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	4.91	1.2	e

Cholestérol HDL

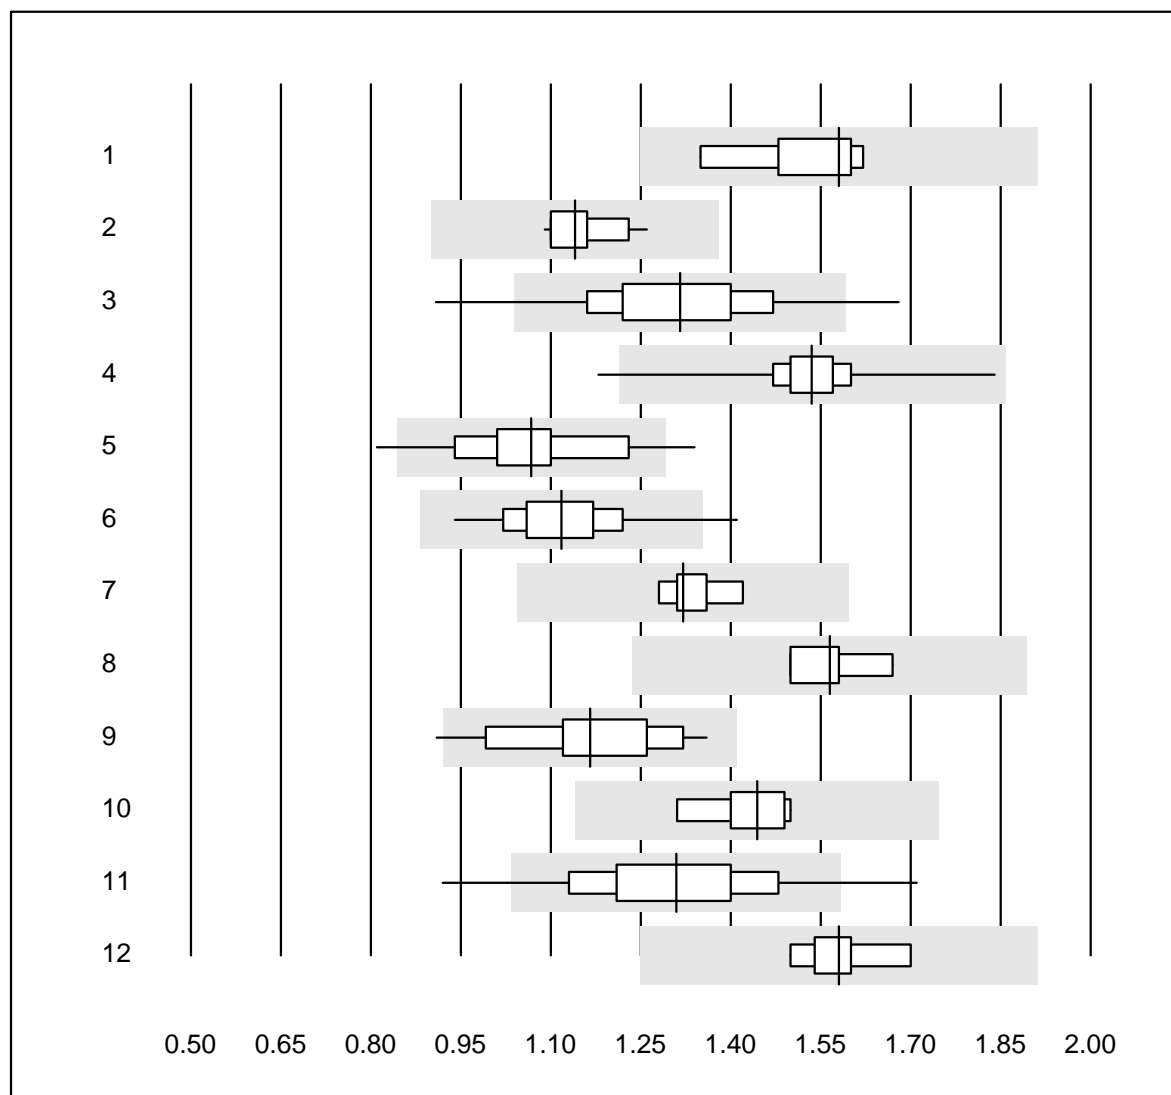


QUALAB Tolérance : 21 %

Cholestérol HDL (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 humide, direct	6	100.0	0.0	0.0	1.58	6.7	e*
2 Cobas	18	94.4	0.0	5.6	1.14	4.2	e
3 Reflotron	224	87.4	6.3	6.3	1.32	10.4	e
4 Fuji Dri-Chem	814	98.9	0.1	1.0	1.54	3.6	e
5 Spotchem SP-4430	63	90.5	6.3	3.2	1.07	10.2	e
6 Spotchem D-Concept	332	96.1	0.9	3.0	1.12	7.0	e
7 Dimension	5	100.0	0.0	0.0	1.32	4.0	e
8 humide, précipitatio	4	100.0	0.0	0.0	1.57	4.5	e
9 Piccolo	19	94.7	5.3	0.0	1.17	9.9	e
10 Pentra/Selectra	9	66.7	0.0	33.3	1.44	4.9	e
11 Cholestech LDX	309	91.2	6.5	2.3	1.31	10.8	e
12 Architect	9	100.0	0.0	0.0	1.58	3.9	e
13 Autolyser/DiaSys	19	100.0	0.0	0.0	1.41	3.9	e

Créatine-kinase

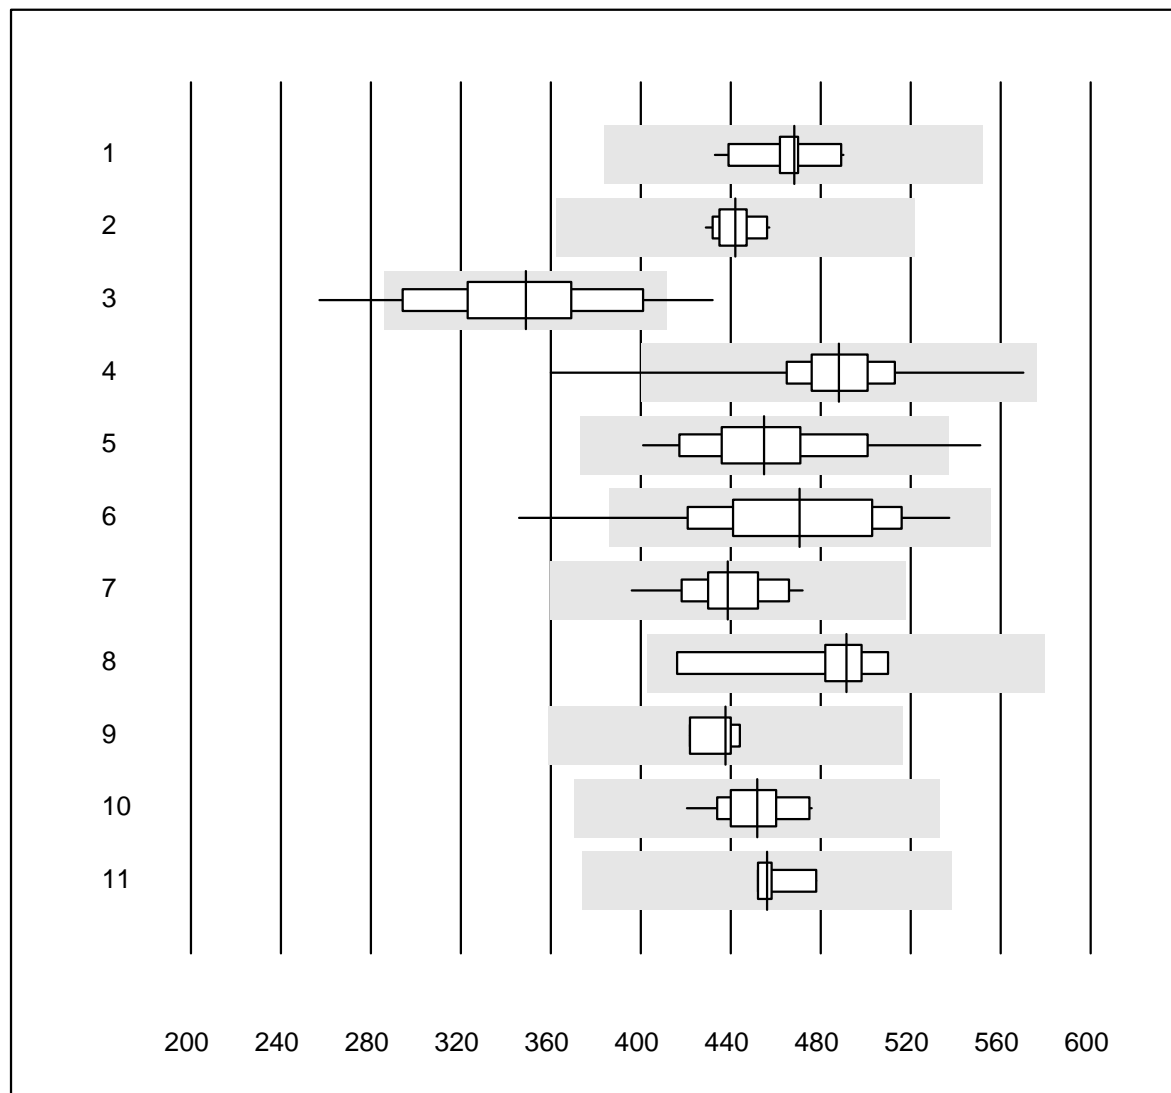


QUALAB Tolérance : 18 %

Créatine-kinase (U/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 IFCC	17	100.0	0.0	0.0	468	3.1	e
2 Cobas	20	100.0	0.0	0.0	442	1.9	e
3 Reflotron	98	82.6	13.3	4.1	349	11.2	e
4 Fuji Dri-Chem	579	97.7	0.7	1.6	488	4.5	e
5 Spotchem SP-4430	28	89.3	3.6	7.1	455	7.3	e
6 Spotchem D-Concept	213	96.7	1.4	1.9	471	8.2	e
7 Piccolo	22	100.0	0.0	0.0	439	4.5	e
8 Selectra Pro	9	100.0	0.0	0.0	492	5.8	e
9 Dimension	4	100.0	0.0	0.0	438	2.2	e
10 Autolyser/DiaSys	15	100.0	0.0	0.0	452	3.5	e
11 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	456	2.6	e

Cholestérol LDL

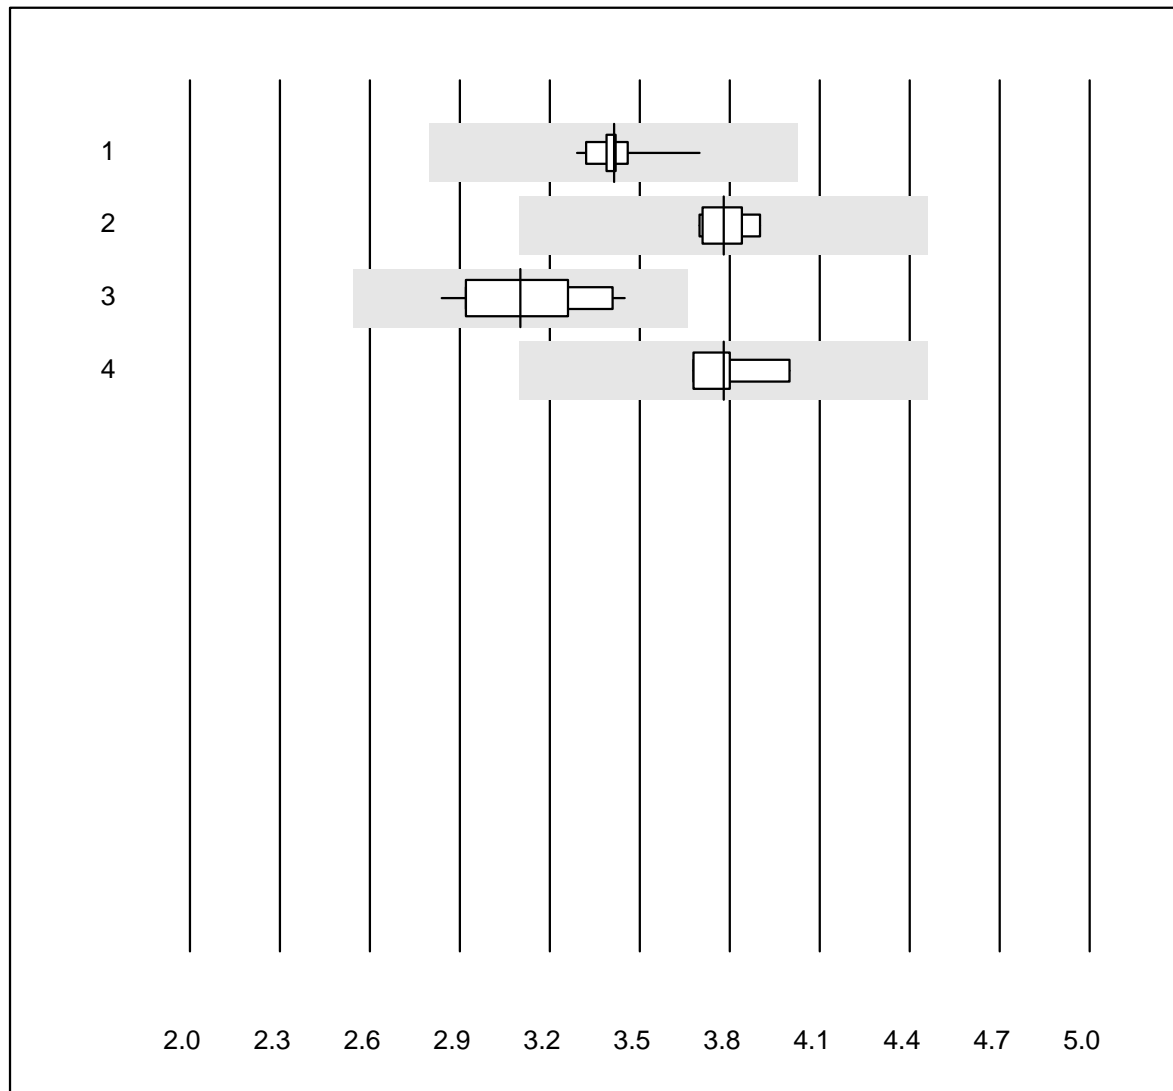


QUALAB Tolérance : 18 %

Cholestérol LDL (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	15	100.0	0.0	0.0	3.4	2.6	e
2 Roche, Cobas	9	100.0	0.0	0.0	3.8	2.0	e
3 Autolyser/DiaSys	12	100.0	0.0	0.0	3.1	6.4	e
4 Beckman	4	100.0	0.0	0.0	3.8	3.6	e

Fer

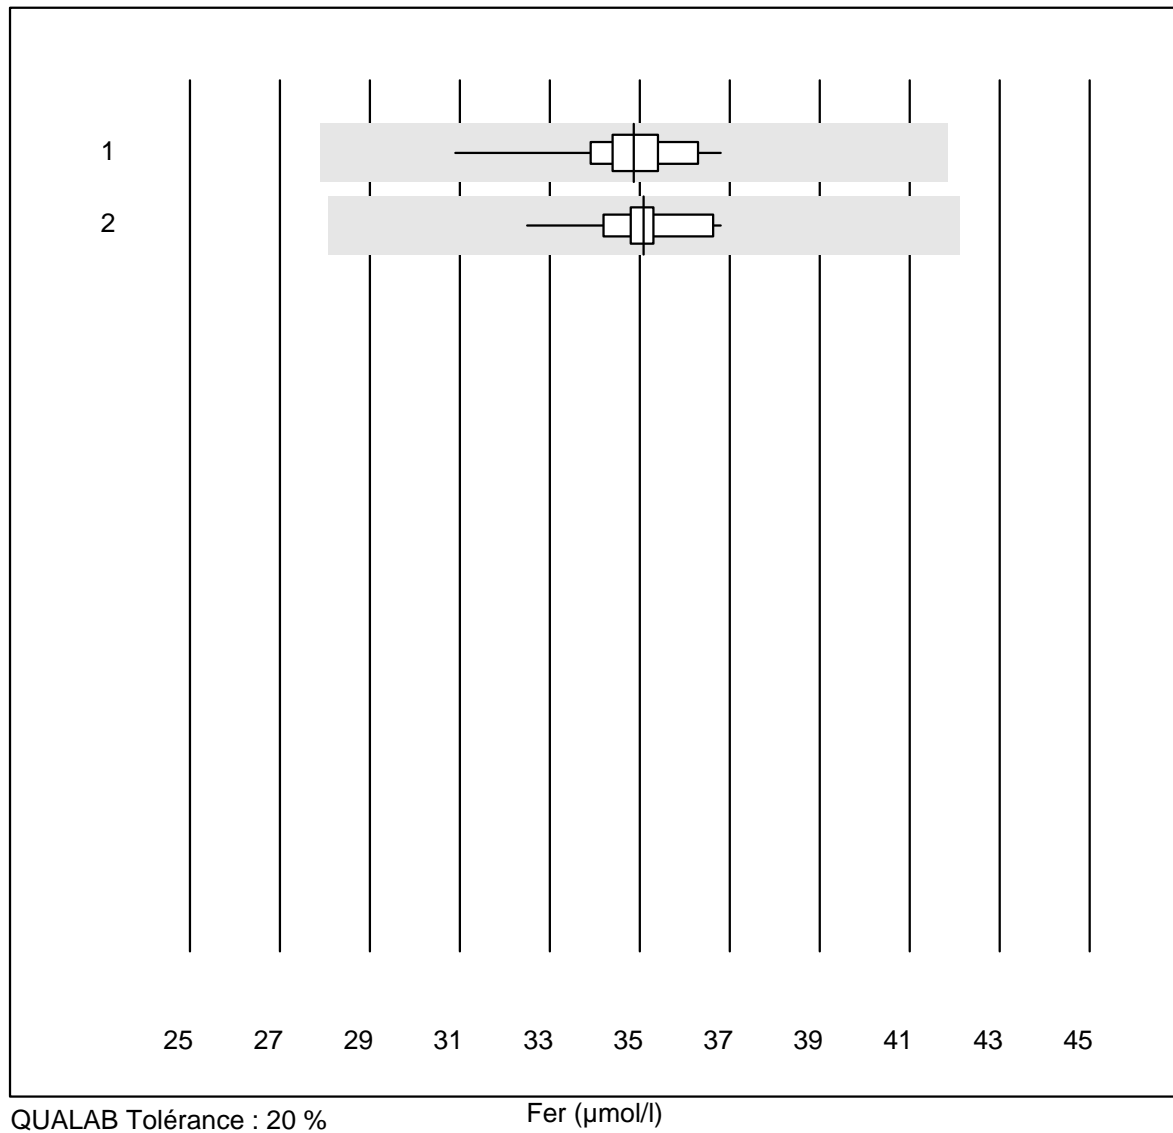


QUALAB Tolérance : 20 %

Fer (µmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	14	100.0	0.0	0.0	35	4.0	e
2 Cobas	12	100.0	0.0	0.0	35	3.1	e

Gamma-GT

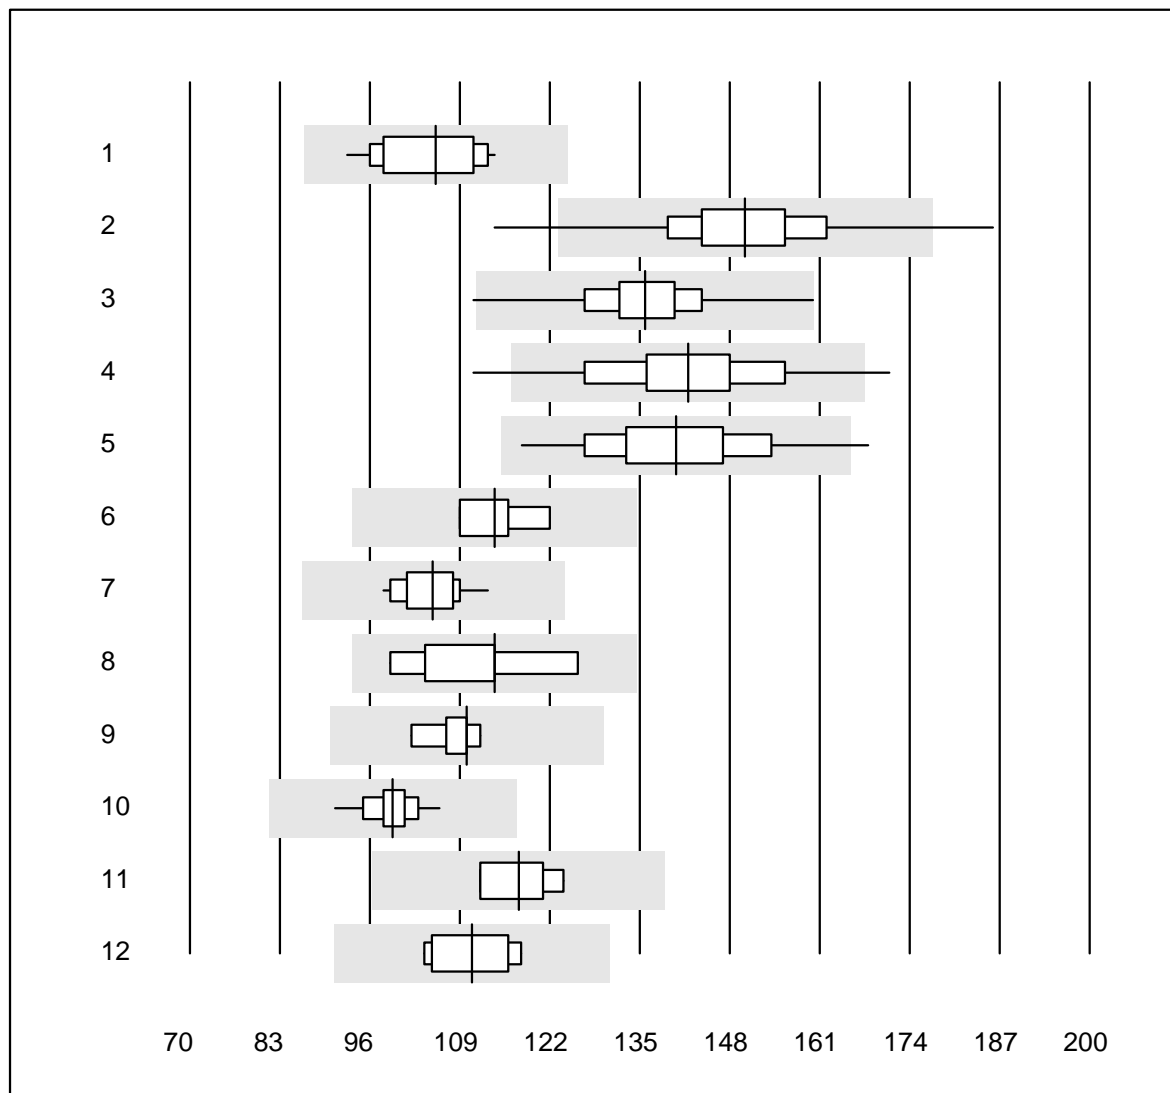


QUALAB Tolérance : 18 %

Gamma-GT (U/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	22	100.0	0.0	0.0	106	6.8	e
2 Reflotron	537	96.5	1.5	2.0	150	6.4	e
3 Fuji Dri-Chem	936	99.6	0.1	0.3	136	4.9	e
4 Spotchem SP-4430	78	97.4	2.6	0.0	142	7.6	e
5 Spotchem D-Concept	381	97.7	0.5	1.8	140	7.4	e
6 Selectra/Biolis	4	100.0	0.0	0.0	114	4.9	e*
7 Architect	12	100.0	0.0	0.0	105	4.3	e
8 Dimension	5	100.0	0.0	0.0	114	9.4	e*
9 IFCC Beckmann	5	100.0	0.0	0.0	110	3.6	e
10 Piccolo	47	97.9	0.0	2.1	99	3.0	e
11 Skyla	4	100.0	0.0	0.0	118	4.8	e*
12 Selectra Pro	7	85.7	0.0	14.3	111	5.1	e
13 Autolyser/DiaSys	19	100.0	0.0	0.0	114	3.8	e

Glucose

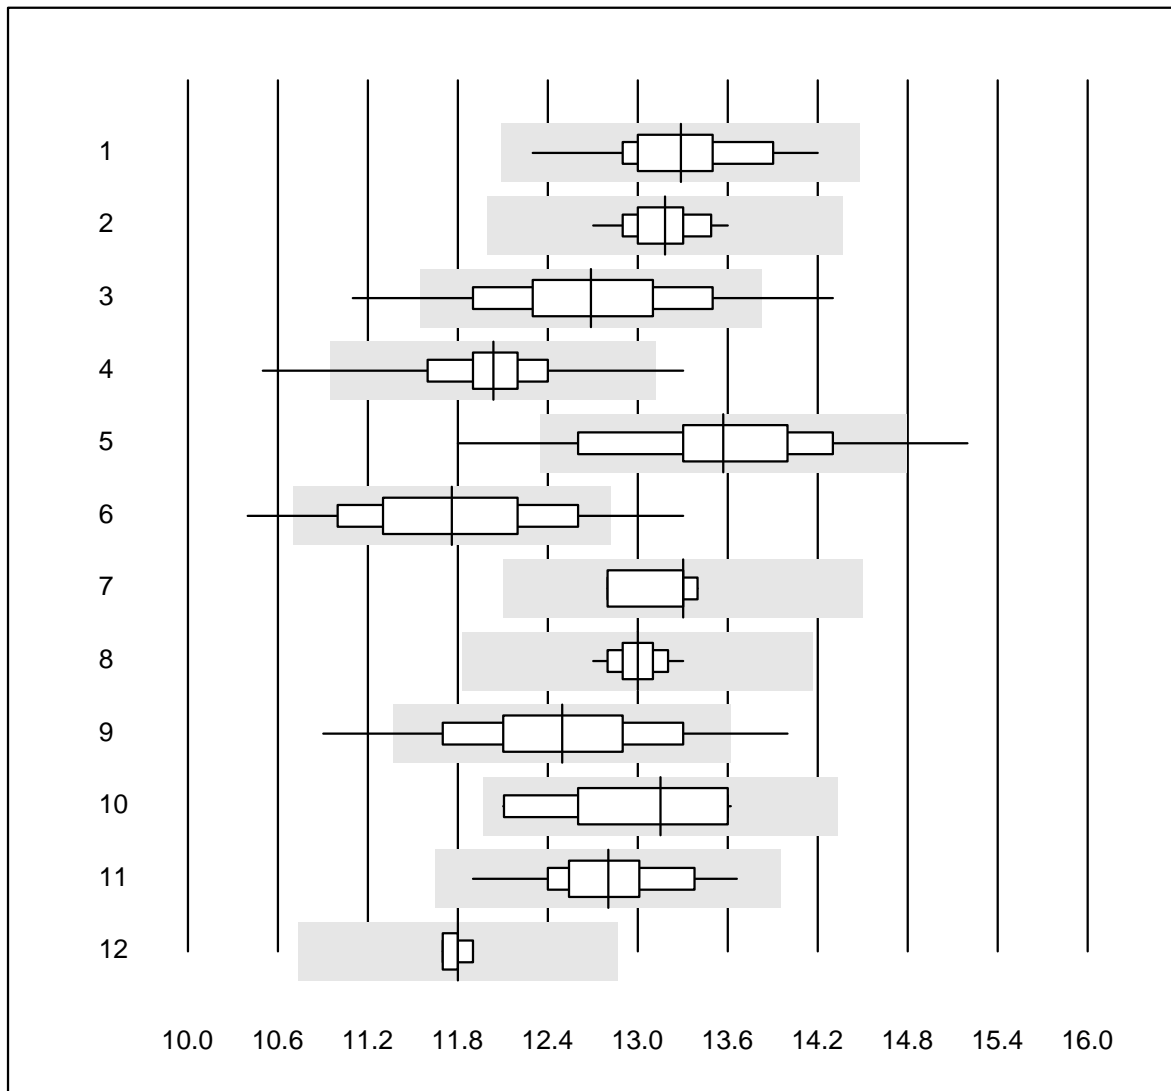


QUALAB Tolérance : 9 %

Glucose (mmol/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	24	95.8	0.0	4.2	13.3	3.4	e
2 Cobas	20	100.0	0.0	0.0	13.2	1.8	e
3 Reflotron	531	88.0	4.7	7.3	12.7	4.7	e
4 Fuji Dri-Chem	889	99.3	0.3	0.4	12.0	2.5	e
5 Spotchem SP-4430	69	79.7	8.7	11.6	13.6	5.1	e
6 Spotchem D-Concept	356	86.5	10.1	3.4	11.8	5.3	e
7 Dimension	4	100.0	0.0	0.0	13.3	2.1	e
8 Piccolo	61	96.7	0.0	3.3	13.0	1.2	e
9 Cholestech LDX	304	93.1	4.9	2.0	12.5	4.8	e
10 Selectra Pro	12	100.0	0.0	0.0	13.2	4.4	e*
11 Autolyser/DiaSys	19	100.0	0.0	0.0	12.8	3.1	e
12 iStat Chem8	7	100.0	0.0	0.0	11.8	0.6	e

Glucose

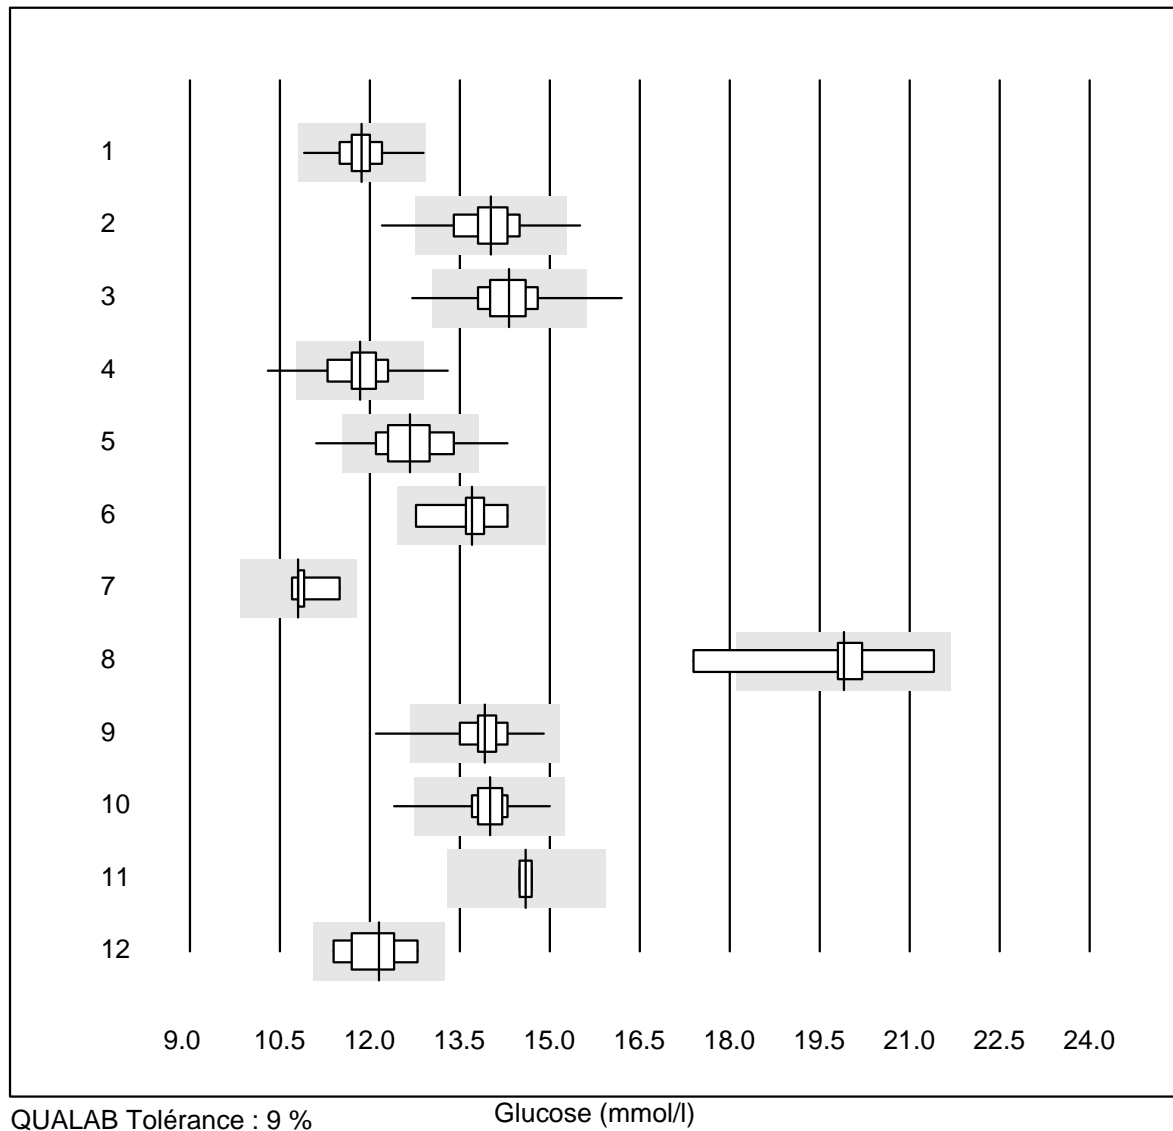


No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	Accu-Chek Instant	71	98.6	0.0	1.4	11.9	2.6	e
2	Accu-Chek Aviva	268	92.9	3.7	3.4	14.0	3.6	e
3	Accu-Chek Inform 2	740	98.4	1.5	0.1	14.3	3.1	e
4	Accu-Check Guide	236	97.0	1.7	1.3	11.8	3.6	e
5	Contour XT	1344	93.6	3.6	2.8	12.7	4.2	e
6	Skyla	5	100.0	0.0	0.0	13.7	4.1	e*
7	Statstrip/Xpress	6	100.0	0.0	0.0	10.8	2.7	e*
8	Glucocard	10	80.0	10.0	10.0	19.9	5.5	e*
9	Hemocue 201+ P-equiv	104	99.0	1.0	0.0	13.9	2.8	e
10	Hemocue 201RT P-equi	124	91.9	0.8	7.3	14.0	2.2	e
11	Freestyle Freedom li	4	75.0	0.0	25.0	14.6	0.8	e
12	Contour NEXT	8	100.0	0.0	0.0	12.2	3.8	e*

Glucose

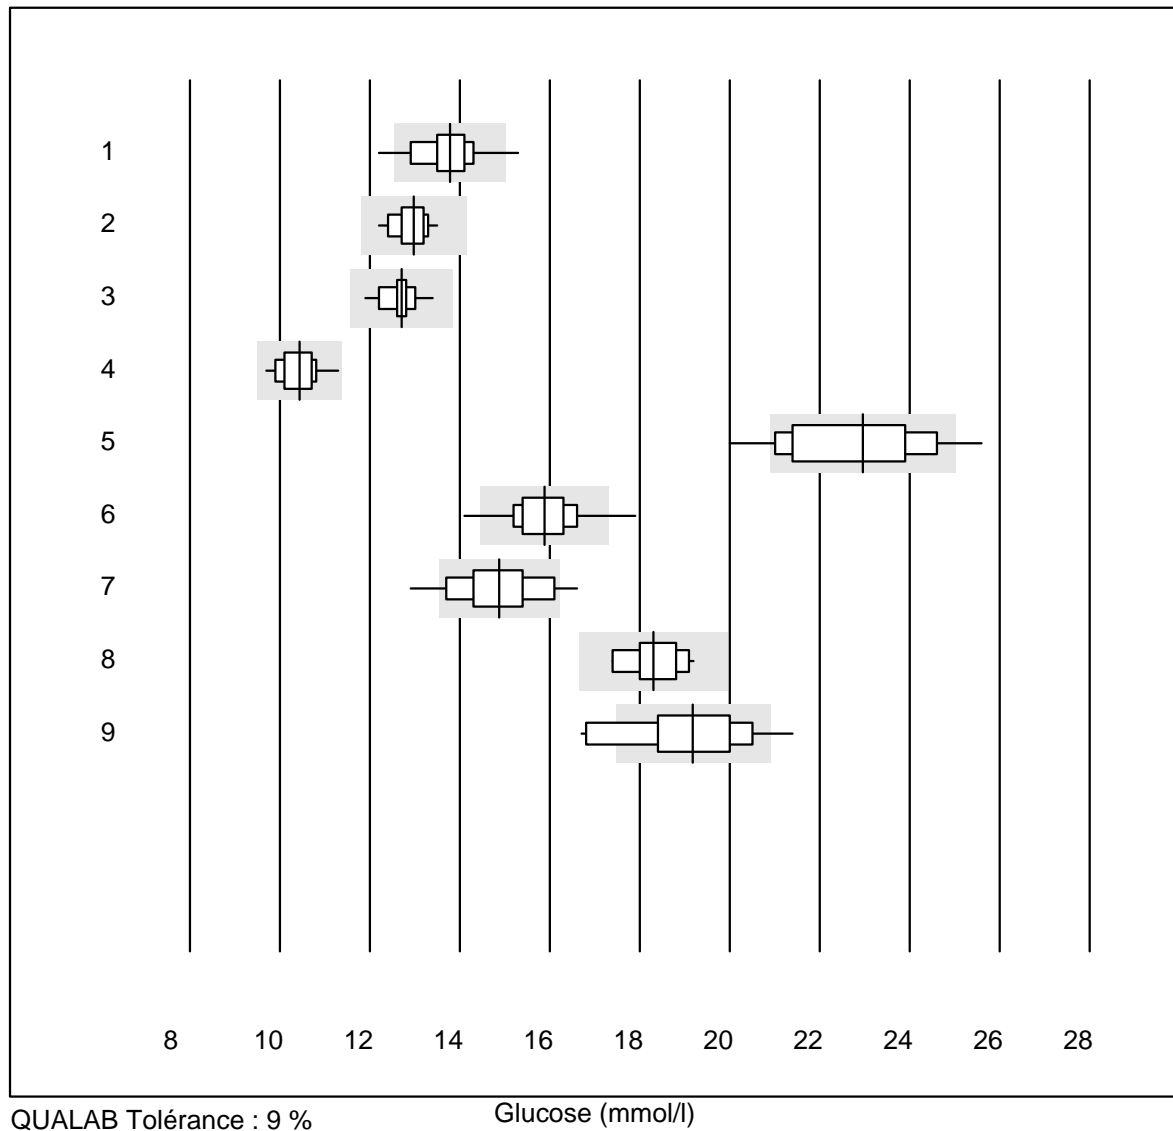

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Hemocue 201+ (alt)	40	90.0	5.0	5.0	13.8	4.1	e
2 AccuChek Sensor	30	100.0	0.0	0.0	13.0	2.7	e
3 OneTouch Verio	22	100.0	0.0	0.0	12.7	2.6	e
4 Contour 2 (5s)	15	93.3	0.0	6.7	10.4	4.0	e
5 Healthpro	26	80.8	11.5	7.7	23.0	6.5	e*
6 Mylife UNIO	357	96.9	1.7	1.4	15.9	3.7	e
7 mylife Pura	74	81.1	8.1	10.8	14.9	5.7	e
8 Omnitest	15	93.3	0.0	6.7	18.3	3.3	e
9 Alpha Check	22	68.2	22.7	9.1	19.2	7.0	e*

Acide urique

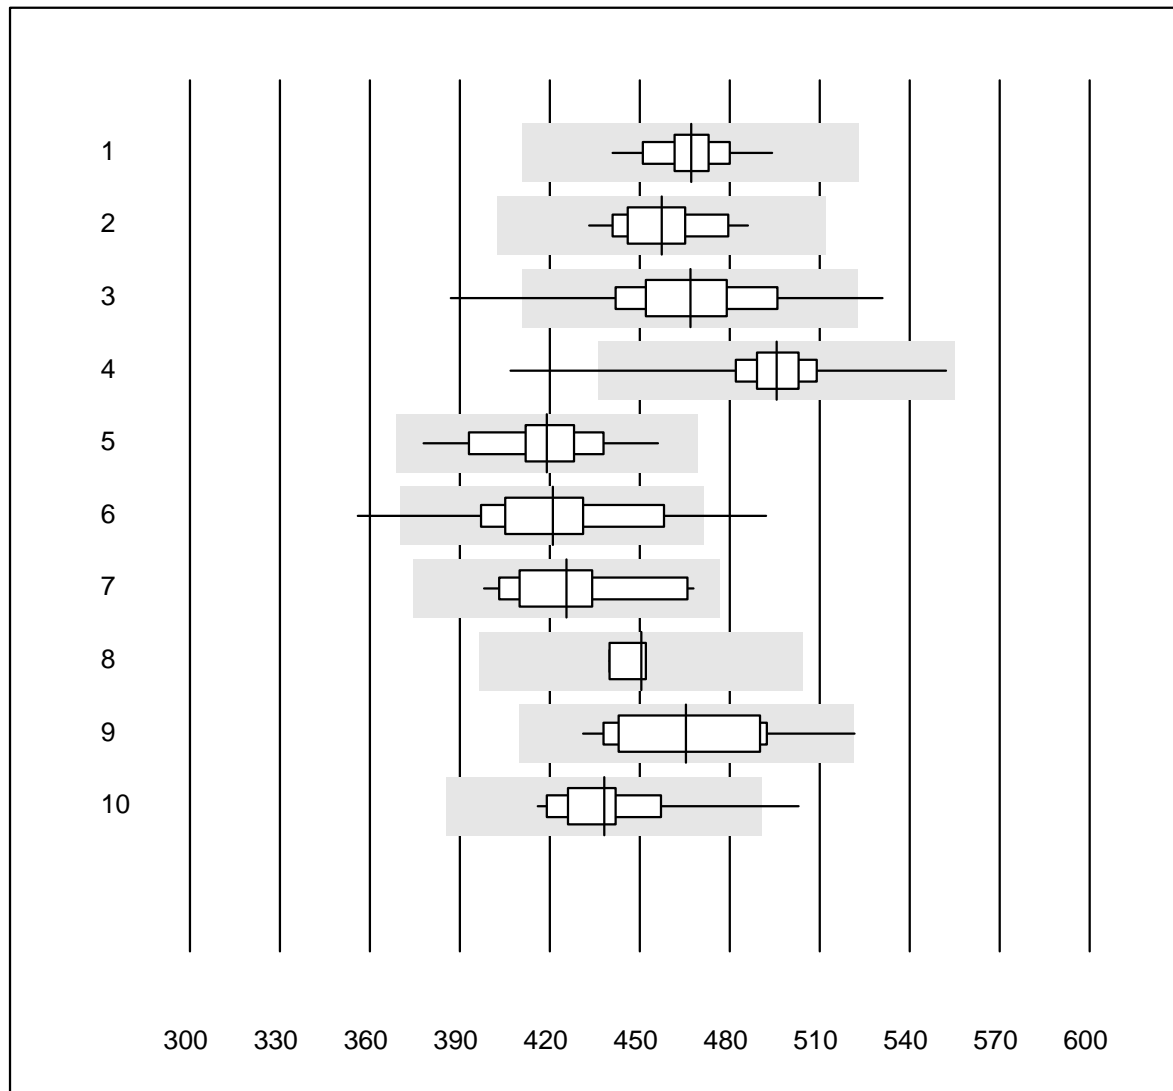


QUALAB Tolérance : 12 %

Acide urique (µmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	28	96.4	0.0	3.6	467	2.4	e
2 Cobas	19	100.0	0.0	0.0	457	3.0	e
3 Reflotron	457	96.7	2.4	0.9	467	4.6	e
4 Fuji Dri-Chem	877	99.4	0.3	0.3	496	2.3	e
5 Spotchem SP-4430	60	98.3	0.0	1.7	419	3.8	e
6 Spotchem D-Concept	354	95.2	4.0	0.8	421	5.5	e
7 Piccolo	30	96.7	0.0	3.3	425	4.6	e
8 Skyla	4	100.0	0.0	0.0	451	1.3	e
9 Selectra Pro	11	90.9	9.1	0.0	465	5.8	e*
10 Autolyser/DiaSys	18	88.8	5.6	5.6	438	4.6	e

Urée

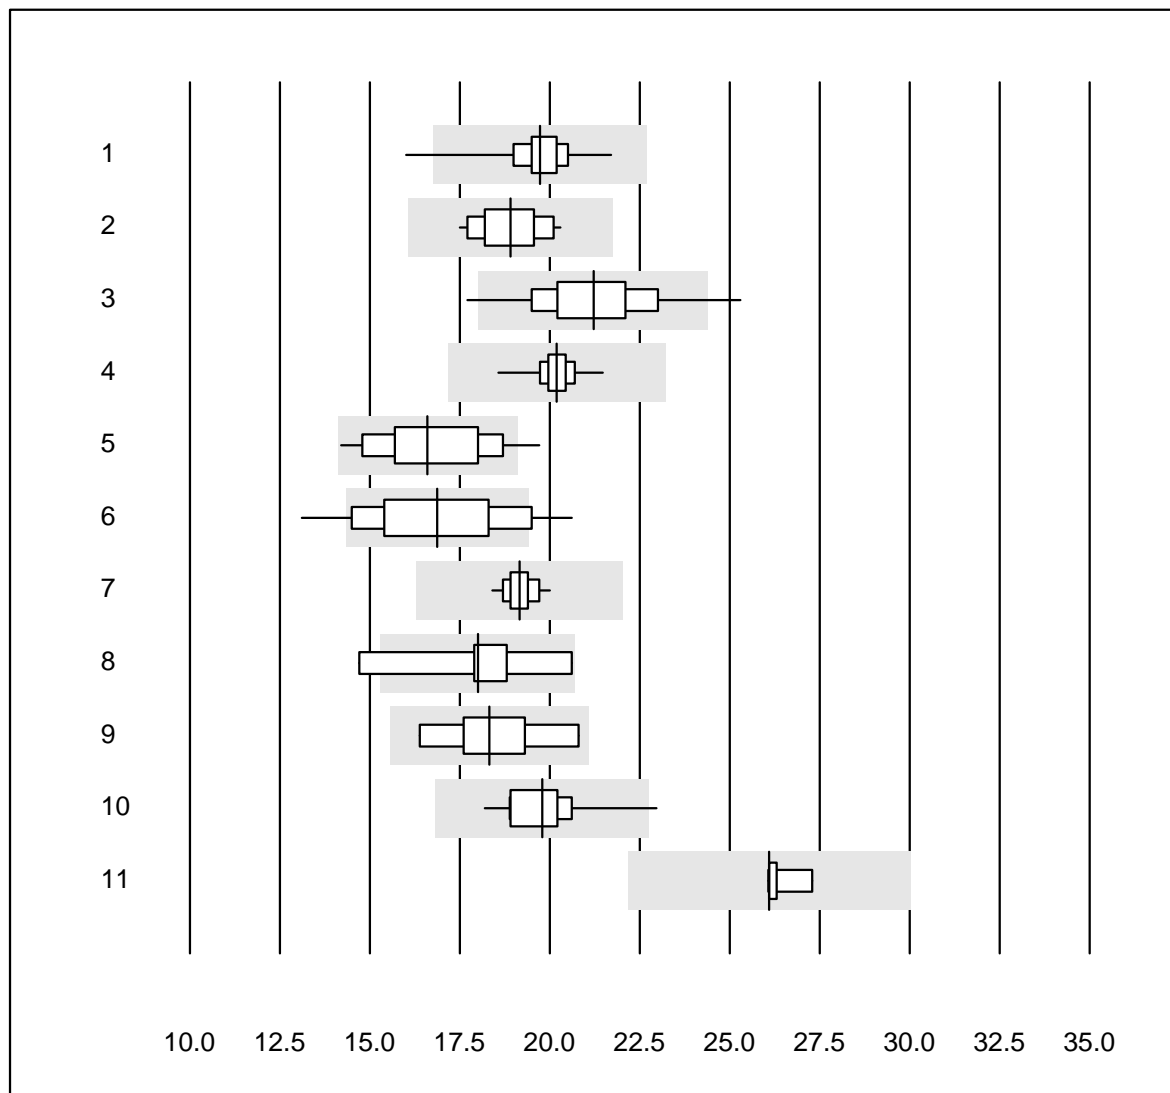


QUALAB Tolérance : 15 %

Urée (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	26	96.2	3.8	0.0	19.7	4.8	e
2 Cobas	19	100.0	0.0	0.0	18.9	4.4	e
3 Reflotron	212	93.8	2.4	3.8	21.2	6.5	e
4 Fuji Dri-Chem	539	99.1	0.0	0.9	20.2	1.9	e
5 Spotchem SP-4430	40	95.0	5.0	0.0	16.6	8.7	e
6 Spotchem D-Concept	213	77.5	17.8	4.7	16.9	10.8	e
7 Piccolo	55	98.2	0.0	1.8	19.2	2.0	e
8 Skyla	5	80.0	20.0	0.0	18.0	11.9	e*
9 Selectra Pro	5	100.0	0.0	0.0	18.3	9.1	e*
10 Autolyser/DiaSys	13	92.3	7.7	0.0	19.8	6.1	e
11 iStat Chem8	6	100.0	0.0	0.0	26.1	1.8	e

Potassium

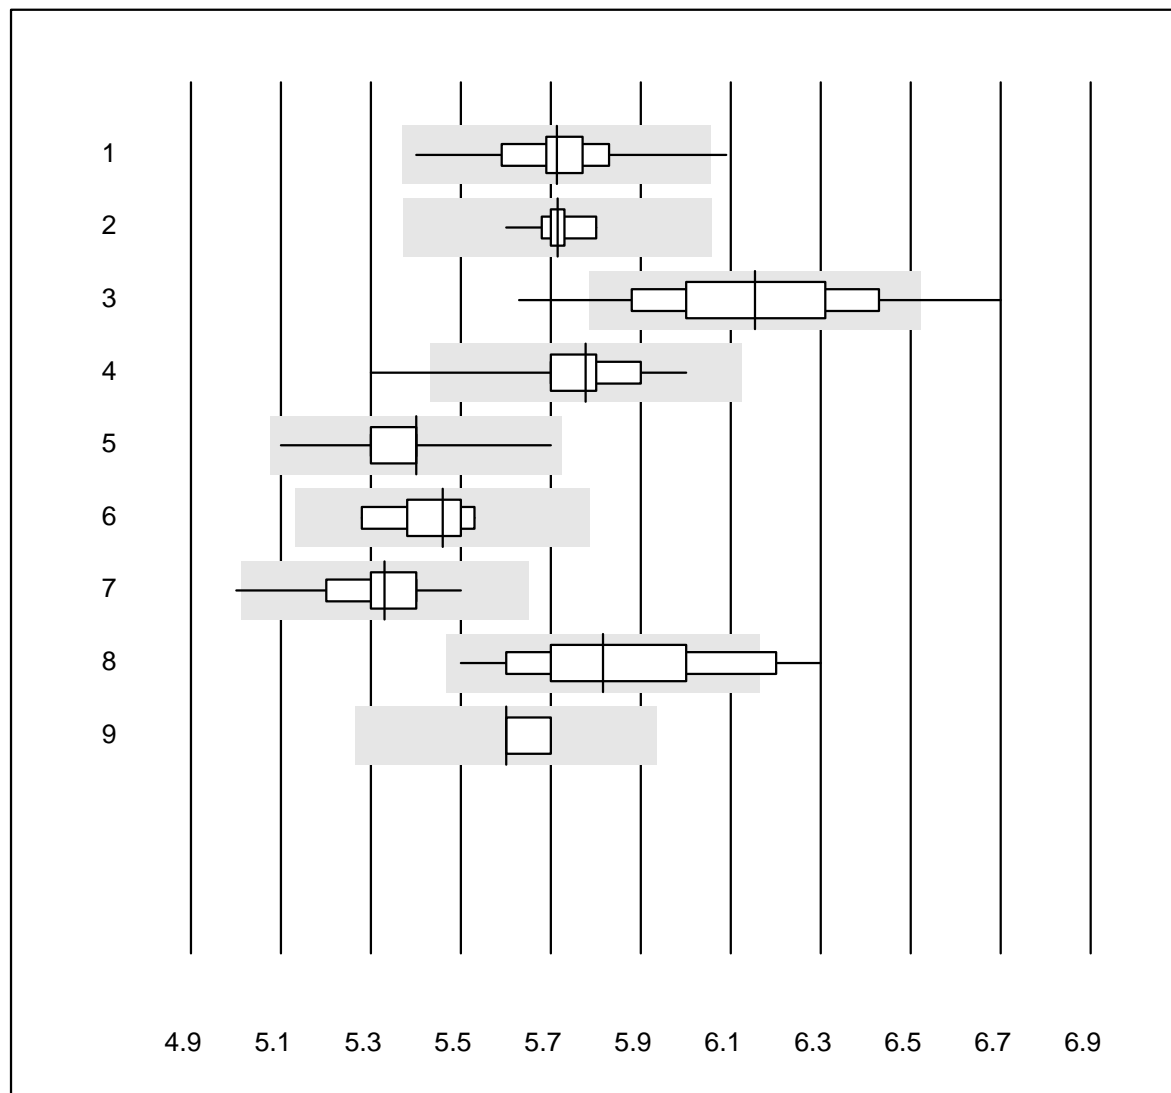


QUALAB Tolérance : 6 %

Potassium (mmol/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 ISE	37	97.3	2.7	0.0	5.71	2.2	e
2 Cobas	21	100.0	0.0	0.0	5.72	0.9	e
3 Reflotron	475	88.6	7.8	3.6	6.15	3.5	e
4 Fuji Dri-Chem	923	97.4	2.2	0.4	5.78	1.9	e
5 Spotchem D-Concept	356	98.6	0.0	1.4	5.40	1.4	e
6 Autolyser/DiaSys	5	100.0	0.0	0.0	5.46	1.9	e*
7 Spotchem EL-SE 1520	62	98.4	1.6	0.0	5.33	2.0	e
8 Piccolo	41	87.8	12.2	0.0	5.82	3.7	e
9 iStat Chem8	8	100.0	0.0	0.0	5.60	0.9	e

Créatinine

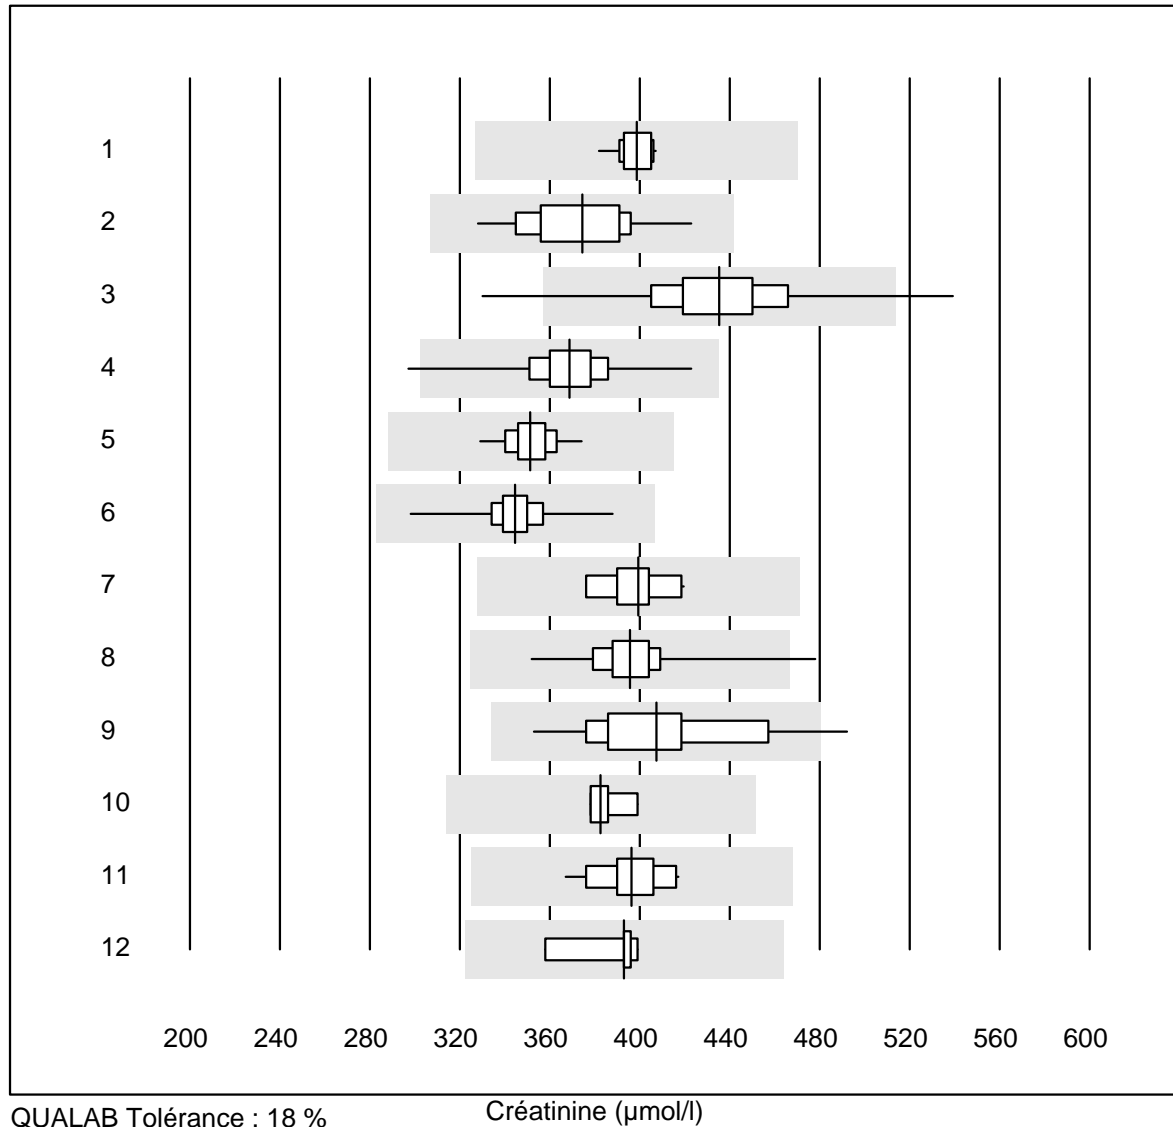

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	12	100.0	0.0	0.0	399	1.9	e
2 Cobas	20	100.0	0.0	0.0	374	6.3	e
3 Reflotron	644	96.1	1.7	2.2	435	6.1	e
4 Fuji Dri-Chem	961	99.4	0.1	0.5	369	3.8	e
5 Spotchem SP-4430	87	100.0	0.0	0.0	351	2.6	e
6 Spotchem D-Concept	382	98.2	0.0	1.8	345	2.9	e
7 Enzymatisch	10	100.0	0.0	0.0	399	3.3	e
8 Piccolo	62	96.8	1.6	1.6	396	4.2	e
9 Selectra Pro	13	92.3	7.7	0.0	407	8.8	e*
10 Skyla	4	100.0	0.0	0.0	383	2.5	e
11 Autolyser/DiaSys	19	100.0	0.0	0.0	396	3.3	e
12 Autres méthodes	5	100.0	0.0	0.0	393	4.3	e
13 EPOC	12	83.3	16.7	0.0	328	12.6	e*

Créatinine E

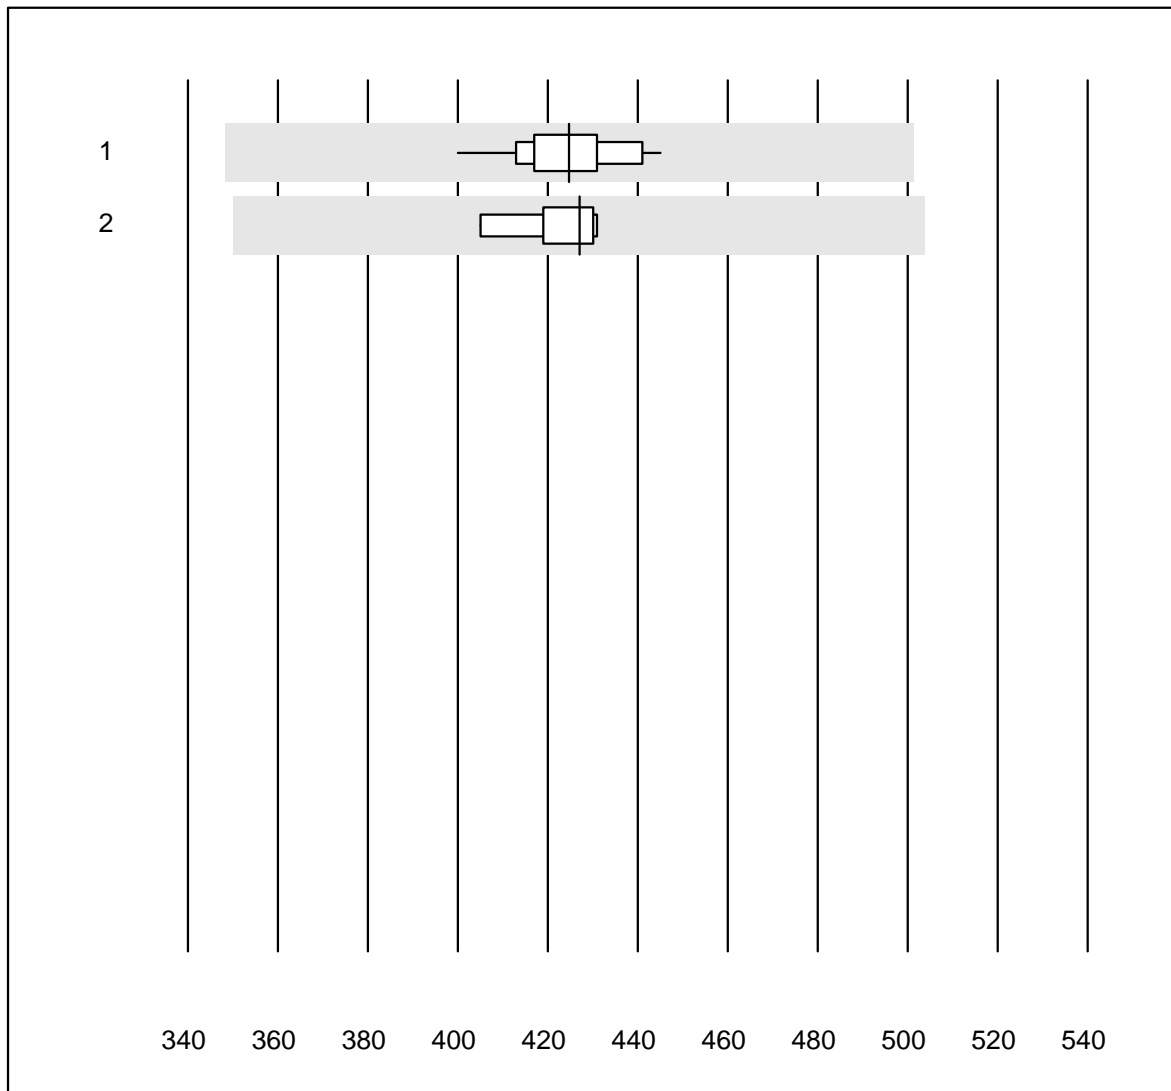


QUALAB Tolérance : 18 %

Créatinine E (µmol/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 iStat Chem8	12	100.0	0.0	0.0	425	2.9	e
2 ABL700/800	7	100.0	0.0	0.0	427	2.2	e

eGFR CKD-EPI

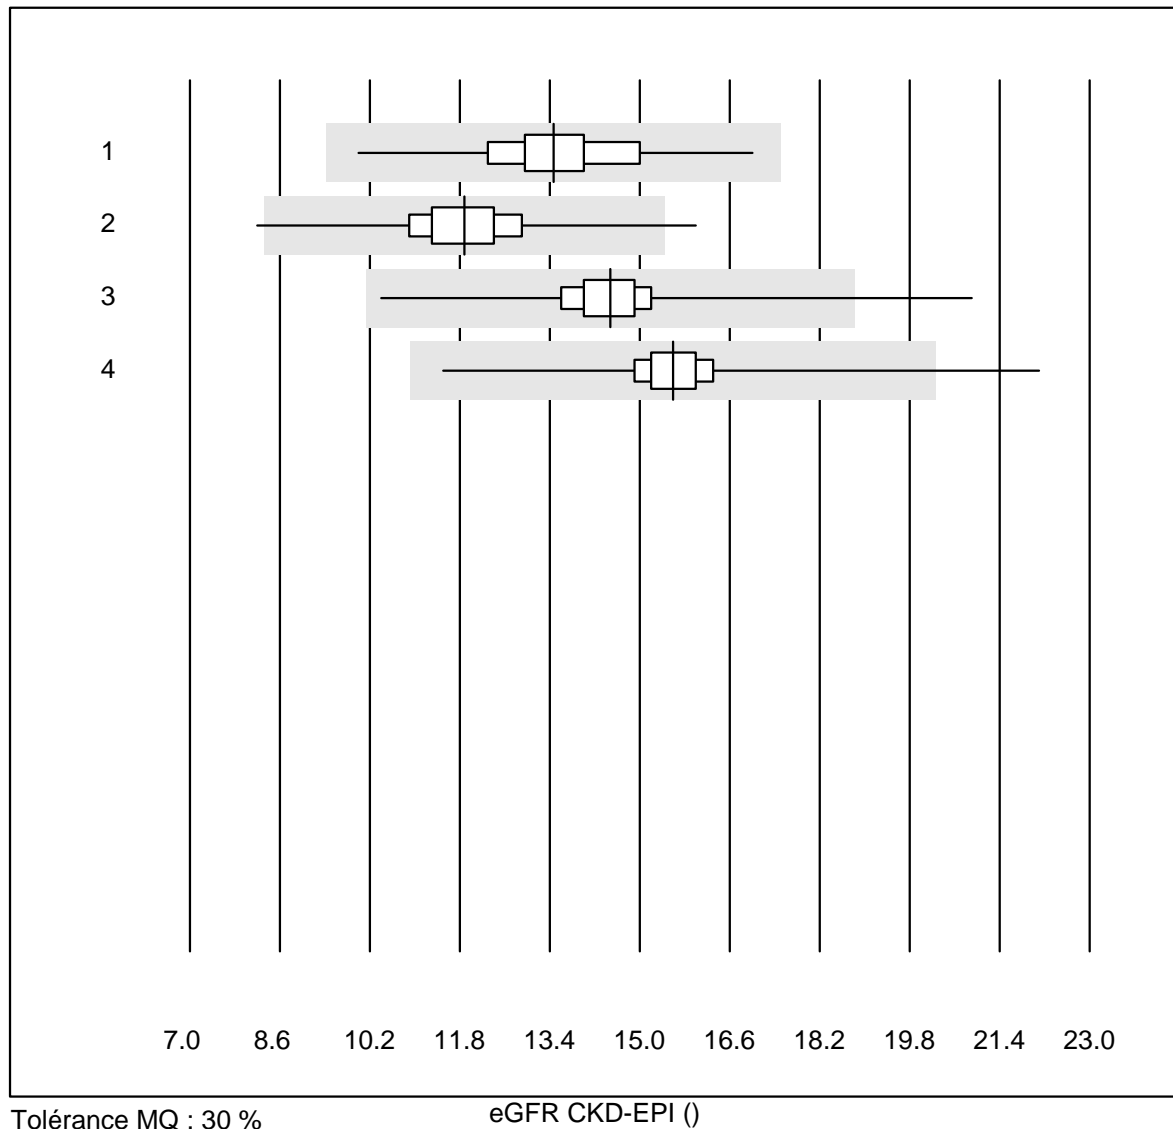


No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	64	96.9	0.0	3.1	13	8.8	e
2 Reflotron	194	96.4	1.5	2.1	12	8.1	e
3 Fuji Dri-Chem	364	96.5	0.8	2.7	14	6.5	e
4 Spotchem SP-4430	164	95.1	0.6	4.3	16	6.1	e

eGFR Cockcroft-Gault

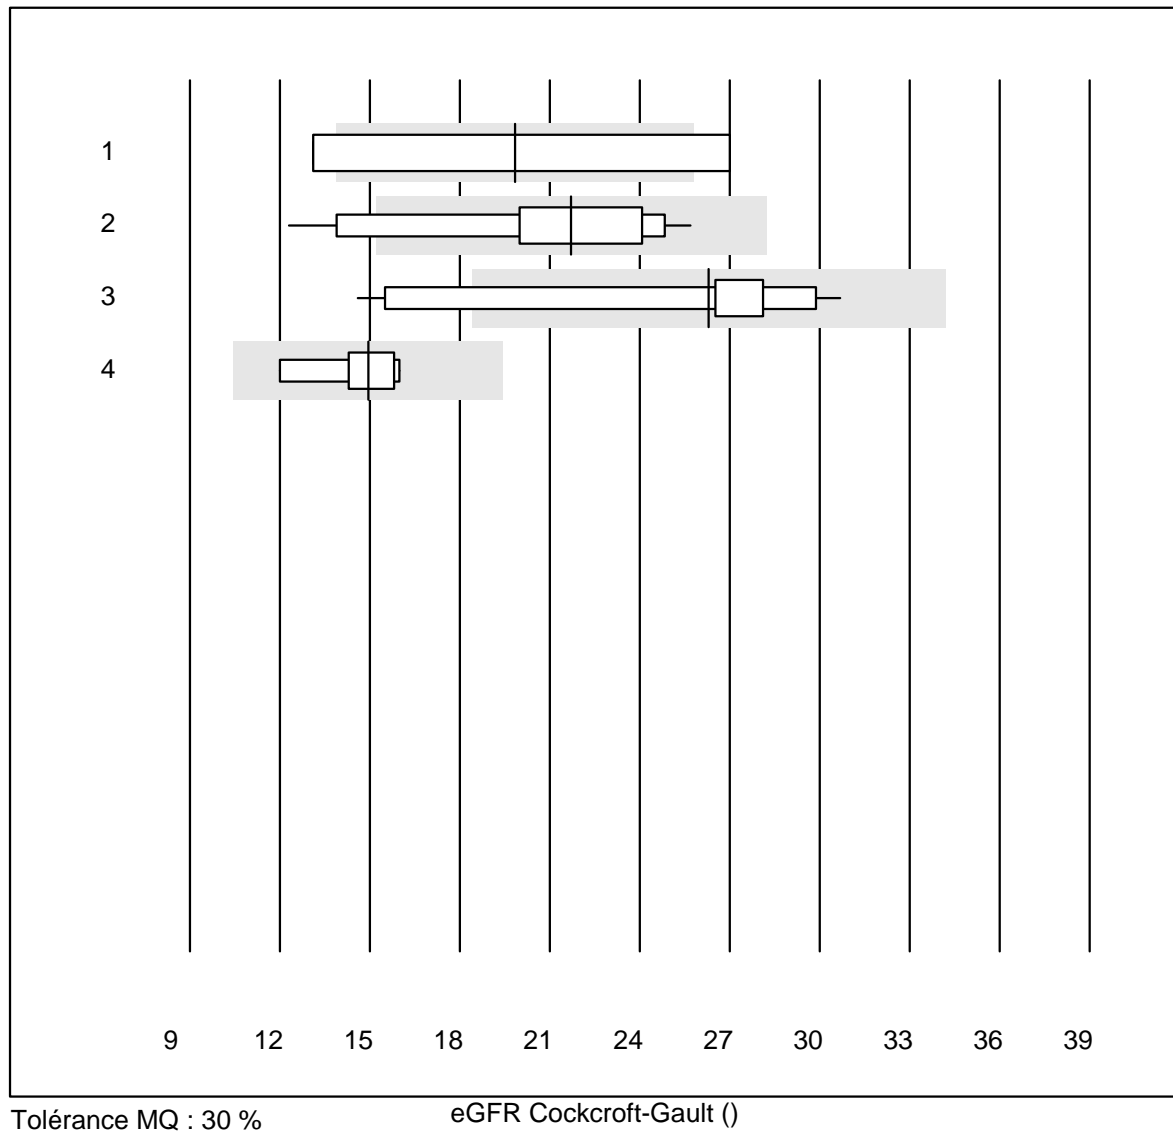

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	4	0.0	75.0	25.0	20	35.6	e*
2 Reflotron	19	73.7	10.5	15.8	22	17.2	e*
3 Fuji Dri-Chem	37	59.5	8.1	32.4	26	17.1	e
4 Spotchem SP-4430	16	56.2	0.0	43.8	15	8.7	e

eGFR MDRD

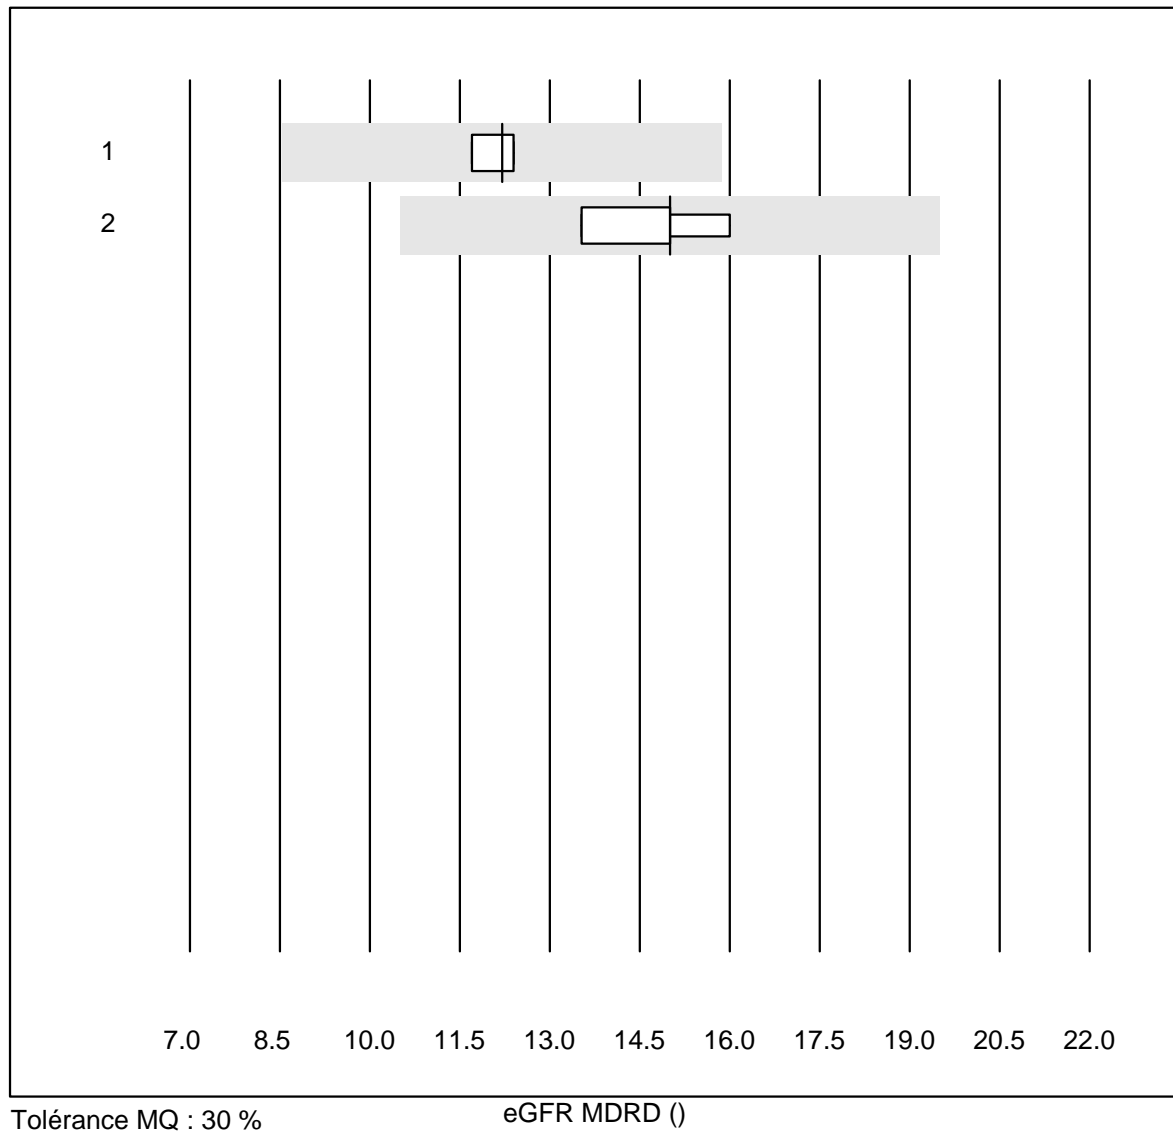


Tolérance MQ : 30 %

eGFR MDRD ()


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Reflotron	4	75.0	0.0	25.0	12	2.9	e
2 Fuji Dri-Chem	5	80.0	0.0	20.0	15	7.2	e

LDH

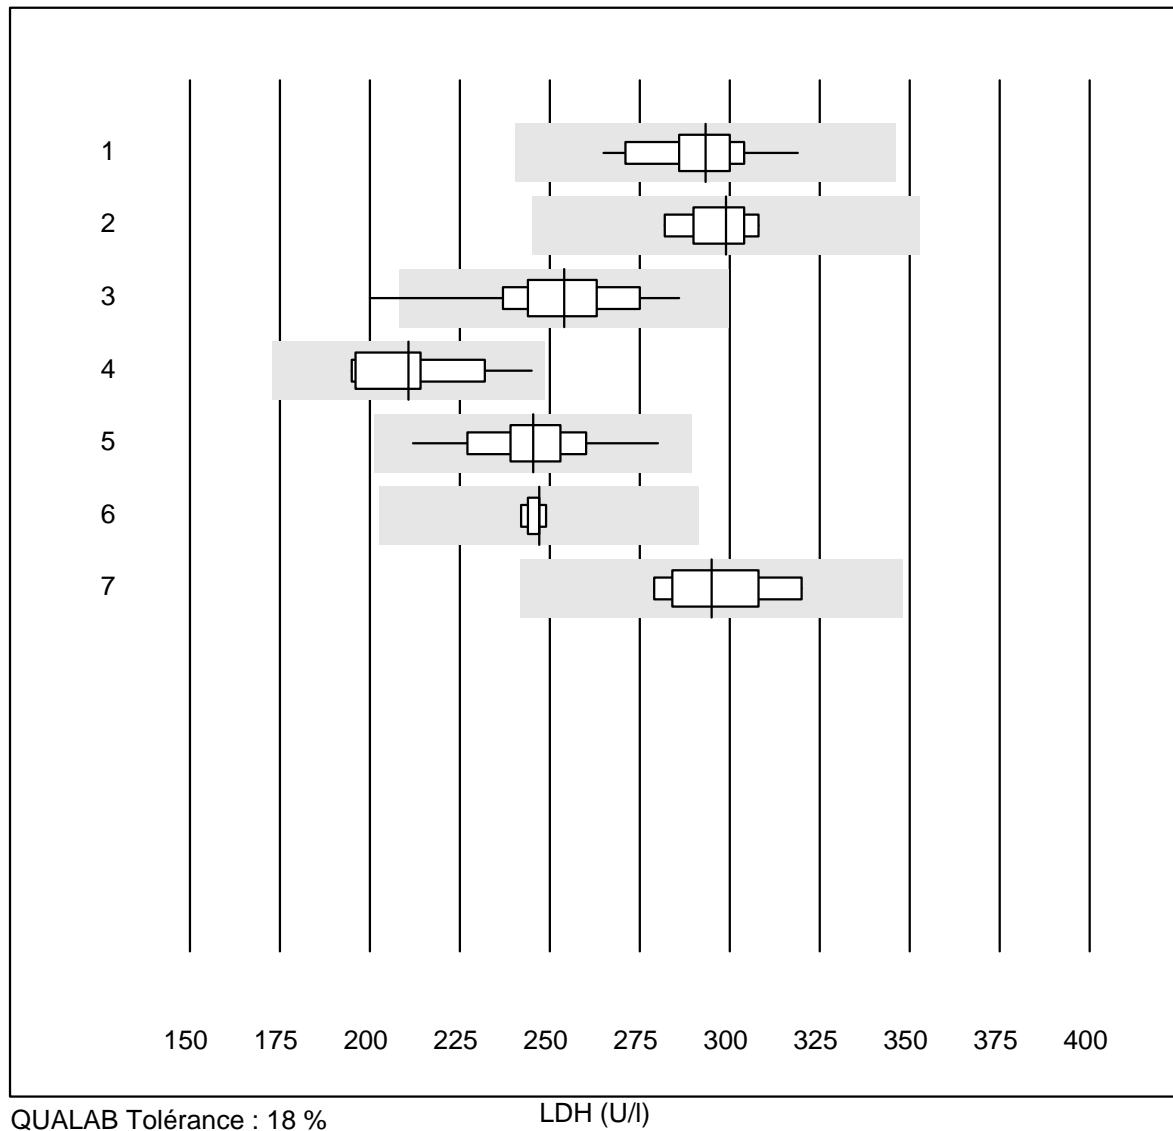


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 IFCC	36	100.0	0.0	0.0	293	3.9	e
2 Cobas	6	100.0	0.0	0.0	299	3.2	e
3 Fuji Dri-Chem	138	98.6	0.7	0.7	254	5.7	e
4 Spotchem SP-4430	12	100.0	0.0	0.0	211	7.3	e
5 Spotchem D-Concept	44	95.5	0.0	4.5	245	5.4	e
6 Piccolo	5	100.0	0.0	0.0	247	1.1	e
7 Autolyser/DiaSys	9	100.0	0.0	0.0	295	4.9	e

Magnésium

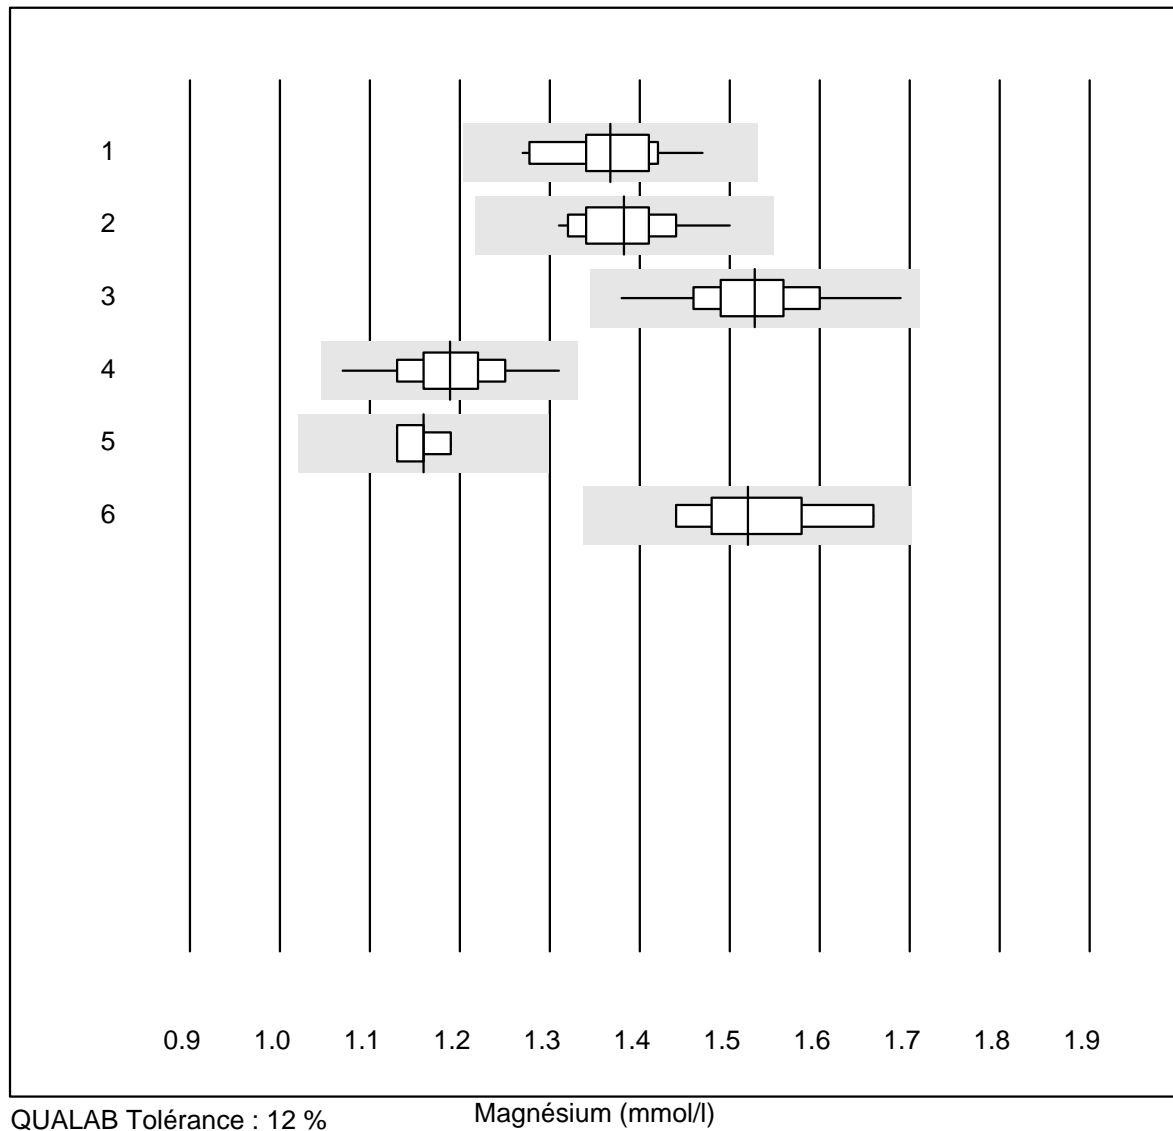

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	20	100.0	0.0	0.0	1.37	3.9	e
2 Cobas	15	100.0	0.0	0.0	1.38	3.6	e
3 Fuji Dri-Chem	112	99.1	0.0	0.9	1.53	3.7	e
4 Spotchem D-Concept	37	97.3	0.0	2.7	1.19	4.2	e
5 Spotchem SP-4430	4	100.0	0.0	0.0	1.16	2.1	e
6 Piccolo	6	100.0	0.0	0.0	1.52	5.2	e*

Sodium

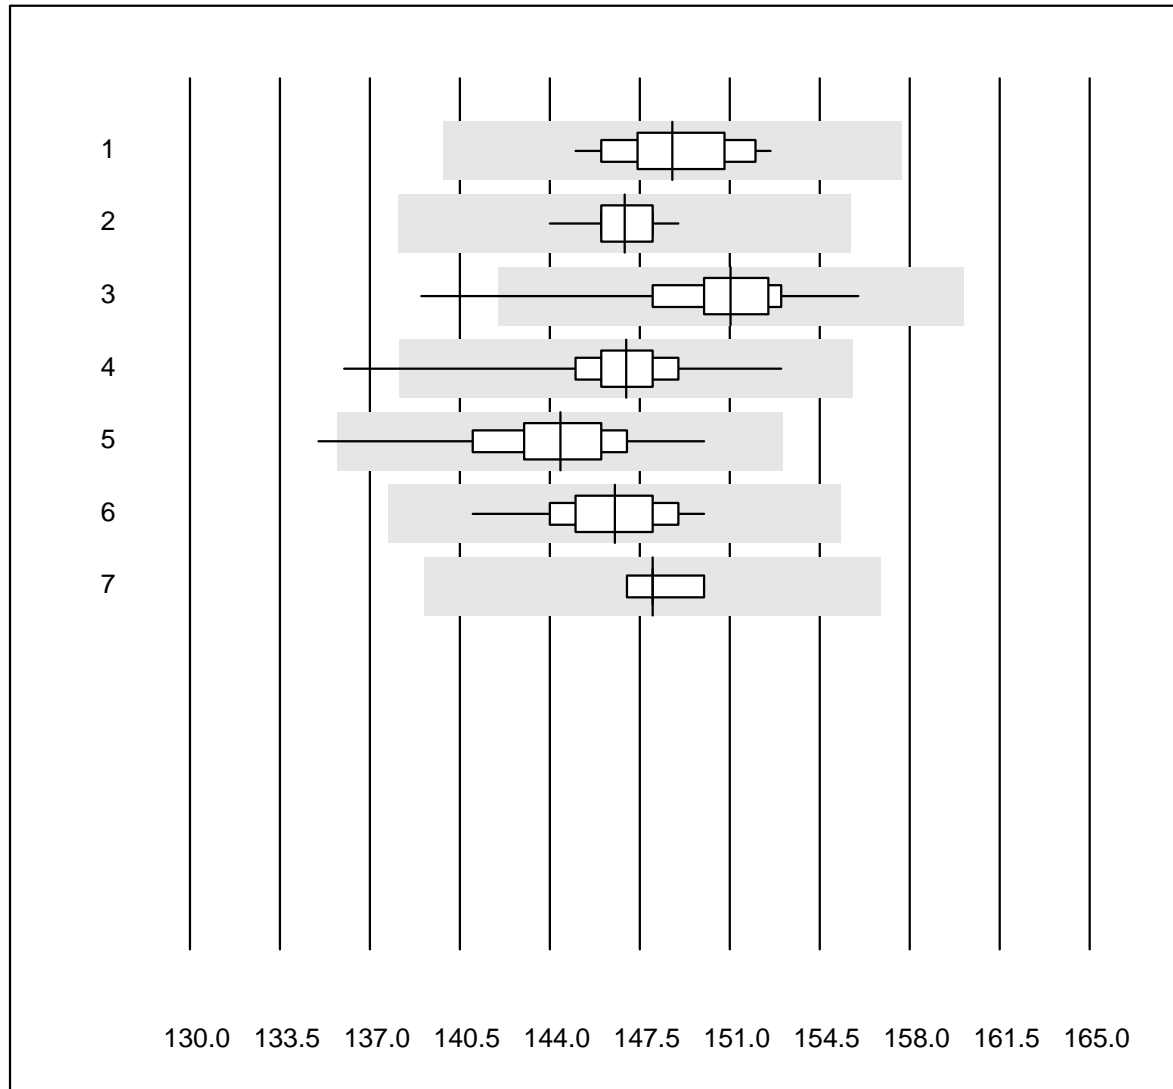


QUALAB Tolérance : 6 %

Sodium (mmol/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 ISE	36	100.0	0.0	0.0	149	1.5	e
2 Cobas	21	100.0	0.0	0.0	147	0.9	e
3 Fuji Dri-Chem	859	98.7	0.8	0.5	151	1.6	e
4 Spotchem D-Concept	332	99.1	0.3	0.6	147	1.3	e
5 Spotchem EL-SE 1520	60	98.3	1.7	0.0	144	1.8	e
6 Piccolo	41	100.0	0.0	0.0	147	1.4	e
7 iStat Chem8	7	100.0	0.0	0.0	148	0.6	e

Phosphates

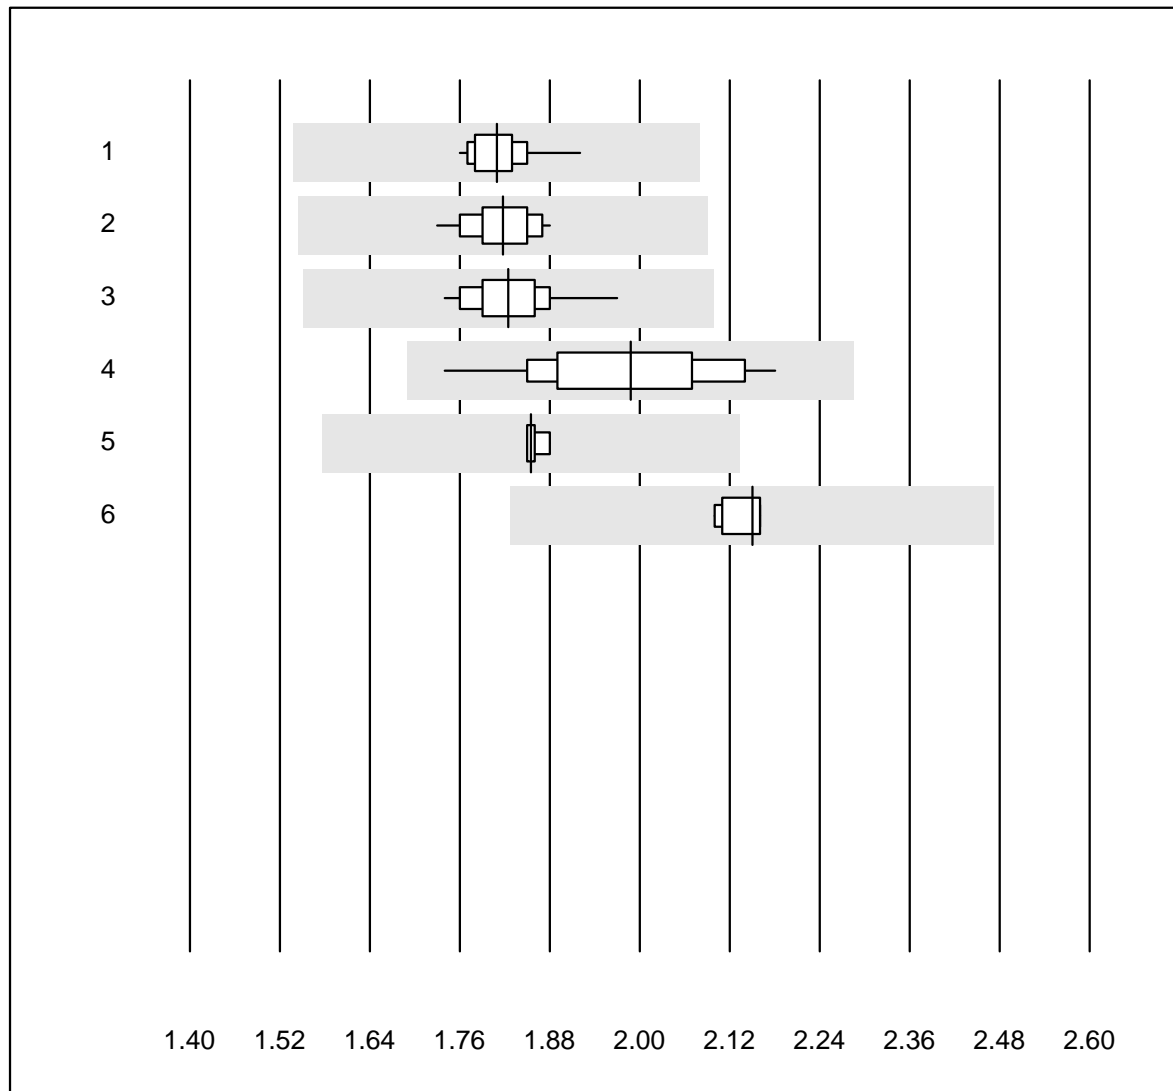


QUALAB Tolérance : 15 %

Phosphates (mmol/l)


No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	Chimie humide	21	100.0	0.0	0.0	1.8	2.3	e
2	Cobas	18	100.0	0.0	0.0	1.8	2.3	e
3	Fuji Dri-Chem	84	100.0	0.0	0.0	1.8	2.5	e
4	Spotchem D-Concept	17	94.1	0.0	5.9	2.0	6.1	e
5	Spotchem SP-4430	4	100.0	0.0	0.0	1.9	0.8	e
6	Piccolo	7	100.0	0.0	0.0	2.2	1.2	e

Protéine

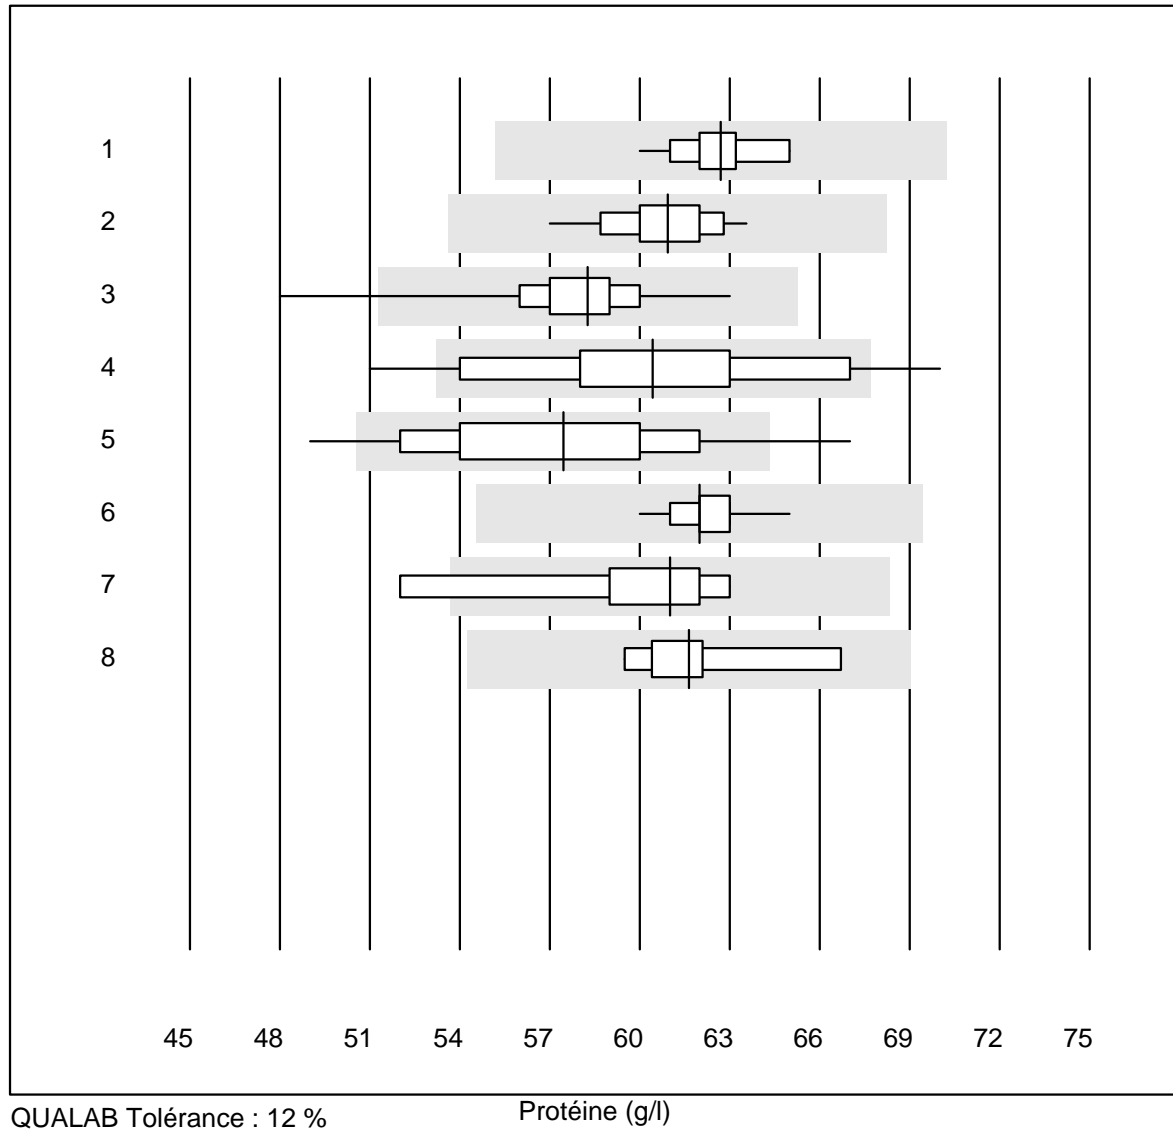

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	22	100.0	0.0	0.0	62.7	2.2	e
2 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	60.9	2.7	e
3 Fuji Dri-Chem	185	97.9	0.5	1.6	58.3	2.9	e
4 Spotchem SP-4430	25	88.0	12.0	0.0	60.4	7.7	e*
5 Spotchem D-Concept	136	87.5	8.1	4.4	57.4	7.0	e
6 Piccolo	43	97.7	0.0	2.3	62.0	1.9	e
7 Skyla	5	80.0	20.0	0.0	61.0	7.4	e*
8 Selectra Pro	7	100.0	0.0	0.0	61.7	3.8	e

Transaminase GOT/AST

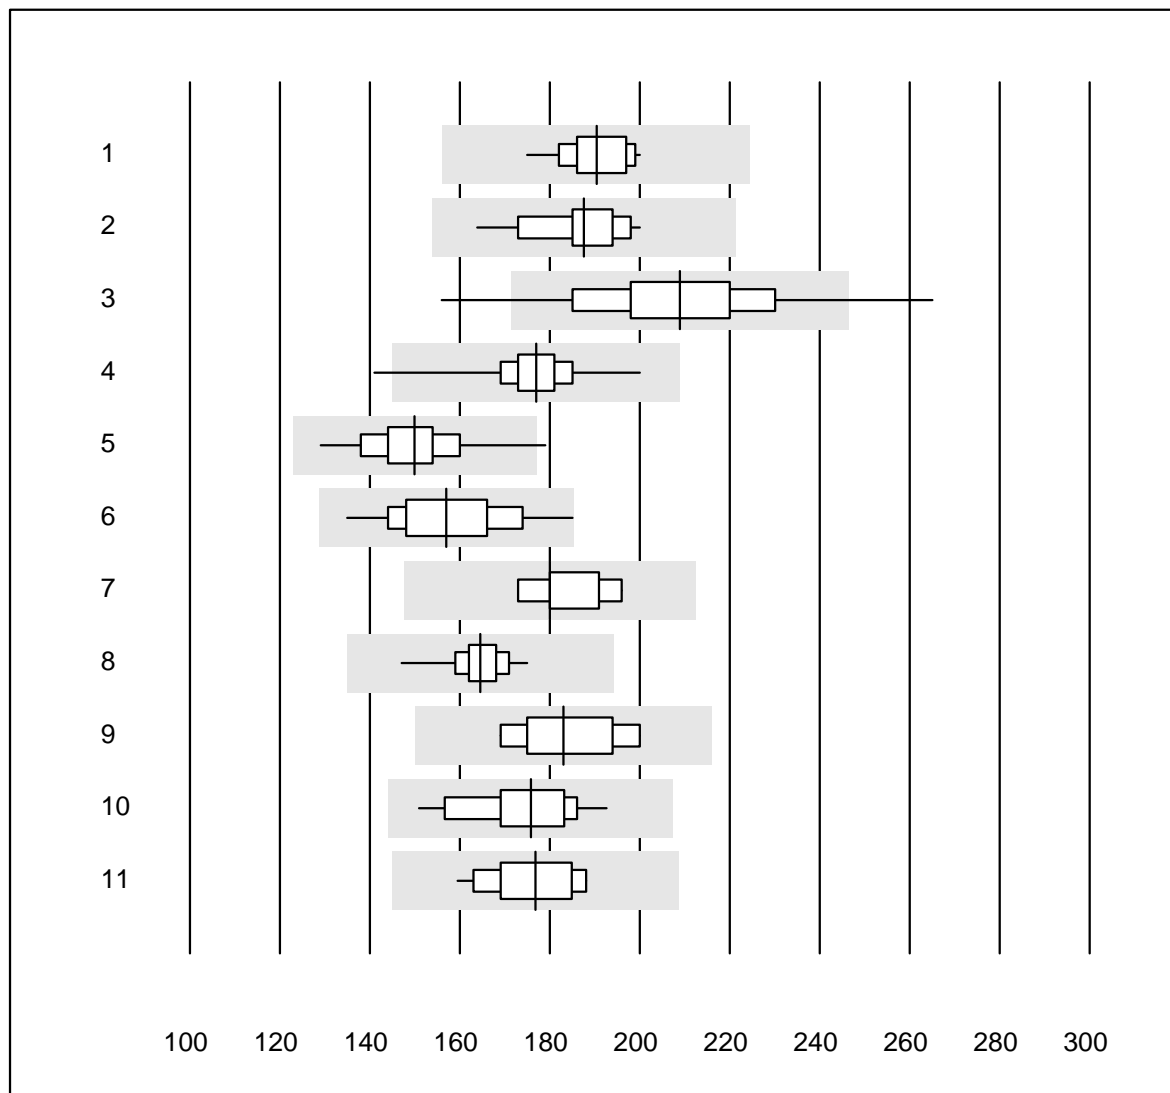


QUALAB Tolérance : 18 %

Transaminase GOT/AST (U/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 IFCC avec PP	25	100.0	0.0	0.0	190	3.6	e
2 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	188	5.5	e
3 Reflotron	550	92.9	4.7	2.4	209	8.5	e
4 Fuji Dri-Chem	948	99.4	0.2	0.4	177	3.9	e
5 Spotchem SP-4430	84	96.4	3.6	0.0	150	6.3	e
6 Spotchem D-Concept	379	99.2	0.0	0.8	157	7.2	e
7 IFCC sens PP	5	100.0	0.0	0.0	180	5.1	e*
8 Piccolo	64	96.9	0.0	3.1	165	3.1	e
9 Skyla	5	100.0	0.0	0.0	183	7.0	e*
10 Selectra Pro	12	100.0	0.0	0.0	176	7.0	e
11 Autolyser/DiaSys	19	100.0	0.0	0.0	177	5.0	e

Transaminase GPT/ALT

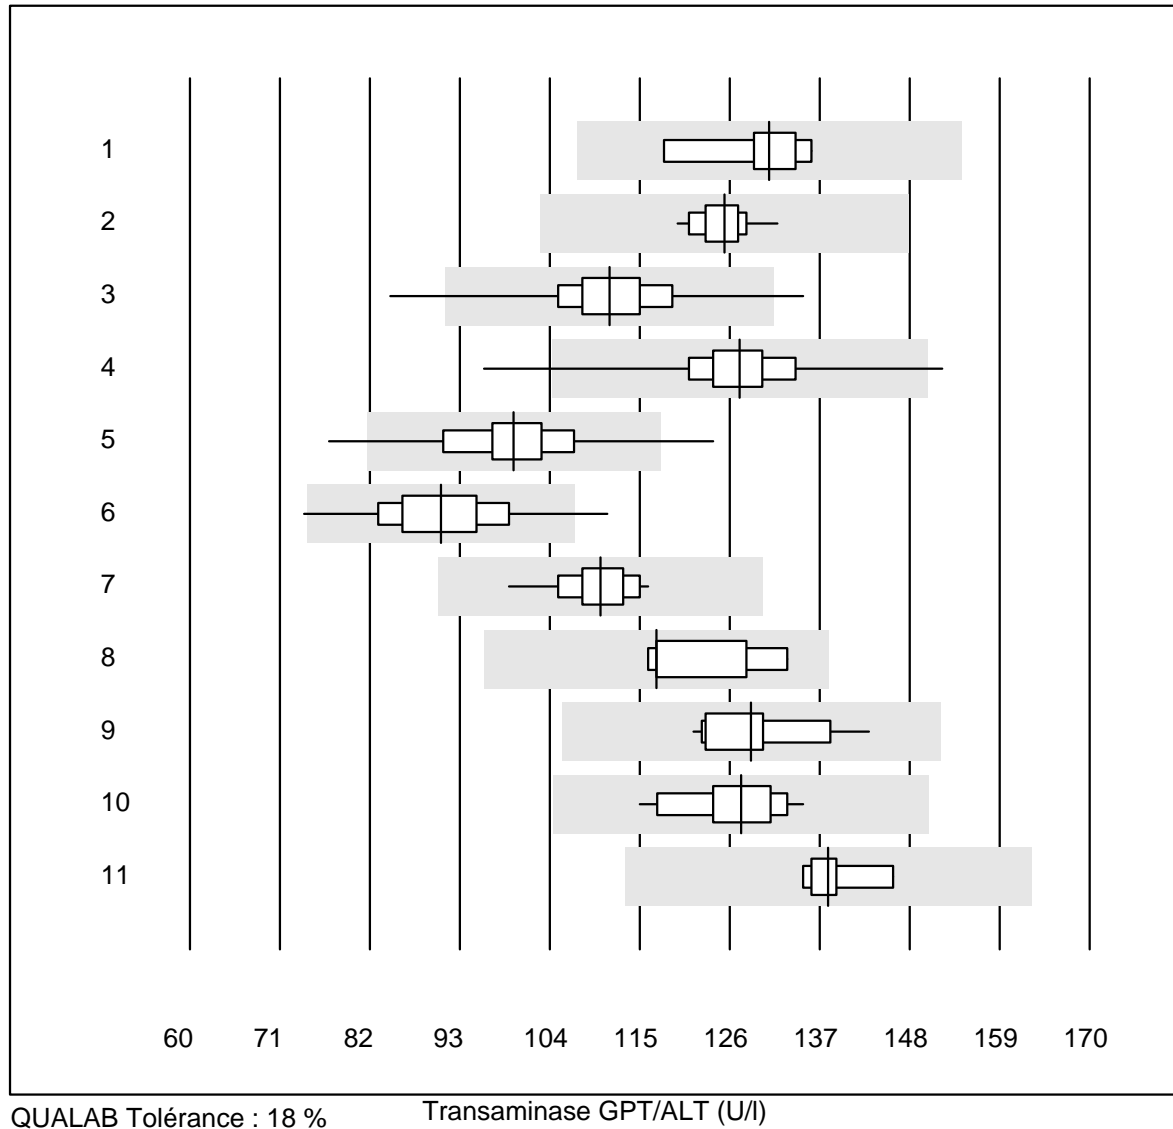

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 IFCC avec PP	20	100.0	0.0	0.0	131	4.2	e
2 Cobas	22	100.0	0.0	0.0	125	2.5	e
3 Reflotron	567	97.7	1.4	0.9	111	5.7	e
4 Fuji Dri-Chem	958	98.8	0.4	0.8	127	4.5	e
5 Spotchem SP-4430	86	96.5	3.5	0.0	100	6.9	e
6 Spotchem D-Concept	383	97.4	1.3	1.3	91	7.0	e
7 Piccolo	63	93.7	0.0	6.3	110	3.3	e
8 Skyla	5	100.0	0.0	0.0	117	6.4	e*
9 Selectra Pro	12	100.0	0.0	0.0	129	5.1	e
10 Autolyser/DiaSys	19	100.0	0.0	0.0	127	4.2	e
11 Autres méthodes	5	100.0	0.0	0.0	138	3.1	e

Triglycérides

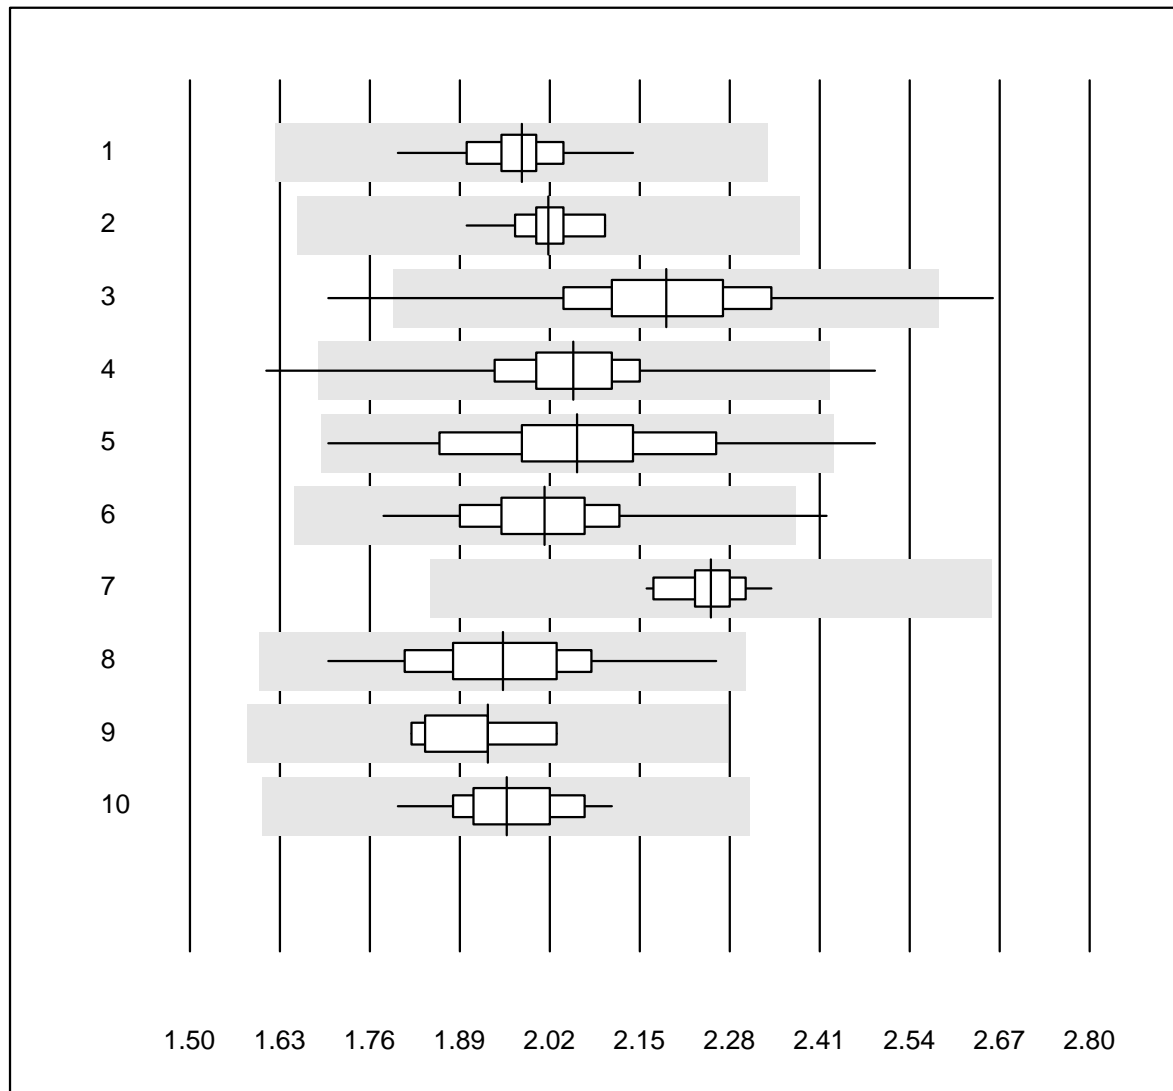


QUALAB Tolérance : 18 %

Triglycérides (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	23	100.0	0.0	0.0	1.98	3.3	e
2 Cobas	21	100.0	0.0	0.0	2.02	2.6	e
3 Reflotron	262	96.2	1.1	2.7	2.19	6.2	e
4 Fuji Dri-Chem	826	99.1	0.2	0.7	2.05	4.2	e
5 Spotchem SP-4430	67	95.5	1.5	3.0	2.06	7.3	e
6 Spotchem D-Concept	335	96.7	0.6	2.7	2.01	4.8	e
7 Piccolo	19	94.7	0.0	5.3	2.25	2.1	e
8 Cholestech LDX	309	99.4	0.0	0.6	1.95	5.4	e
9 Selectra Pro	10	80.0	0.0	20.0	1.93	3.7	e
10 Autolyser/DiaSys	19	100.0	0.0	0.0	1.96	4.1	e

Lithium

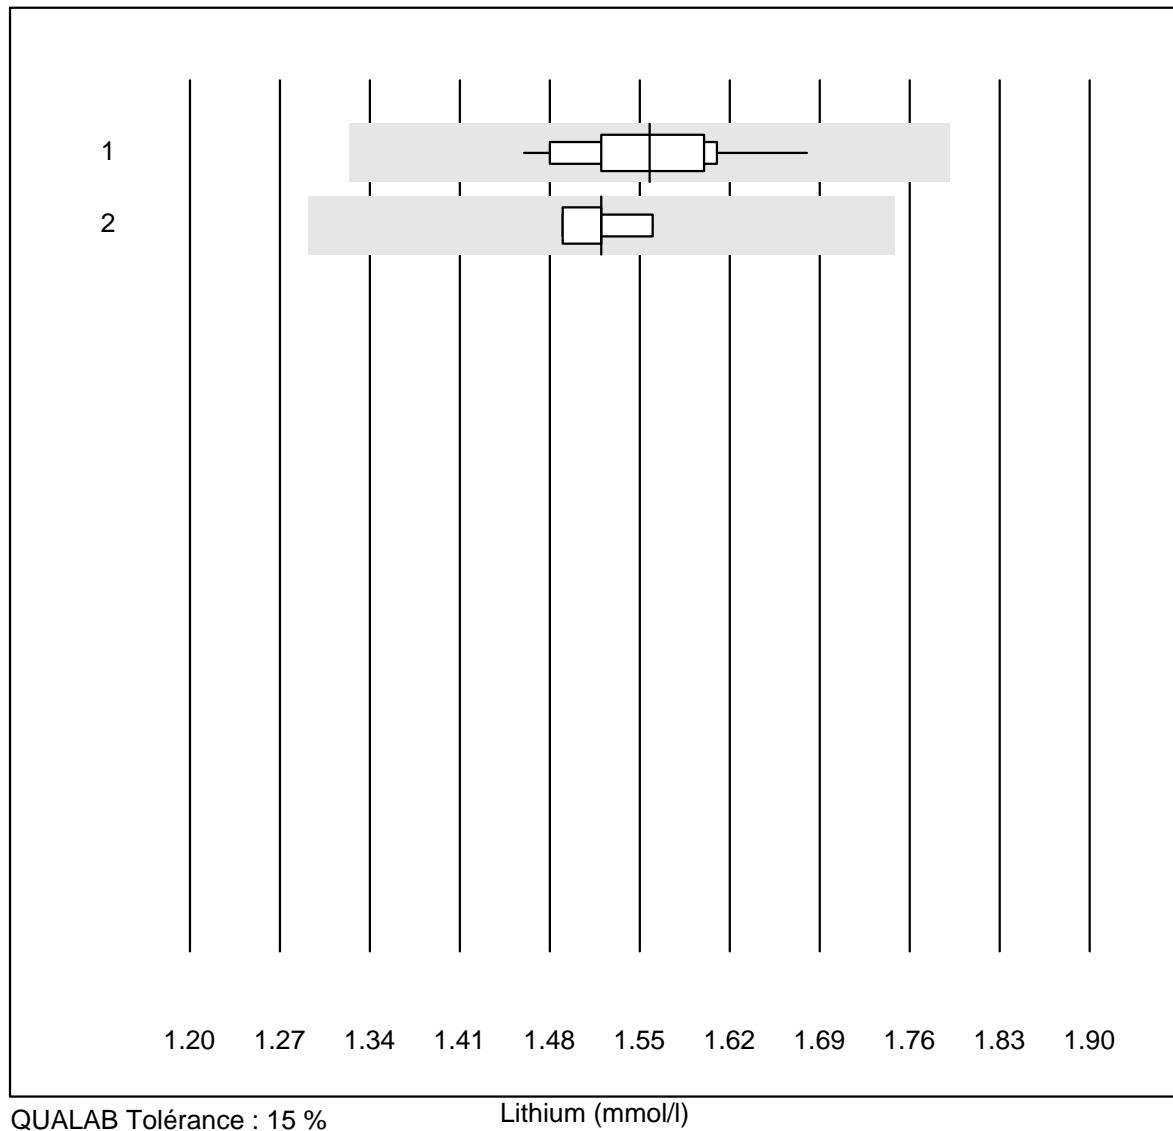


QUALAB Tolérance : 15 %

Lithium (mmol/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	18	100.0	0.0	0.0	1.56	3.5	e
2 Cobas Integra 800/40	4	100.0	0.0	0.0	1.52	1.9	e

Laktat

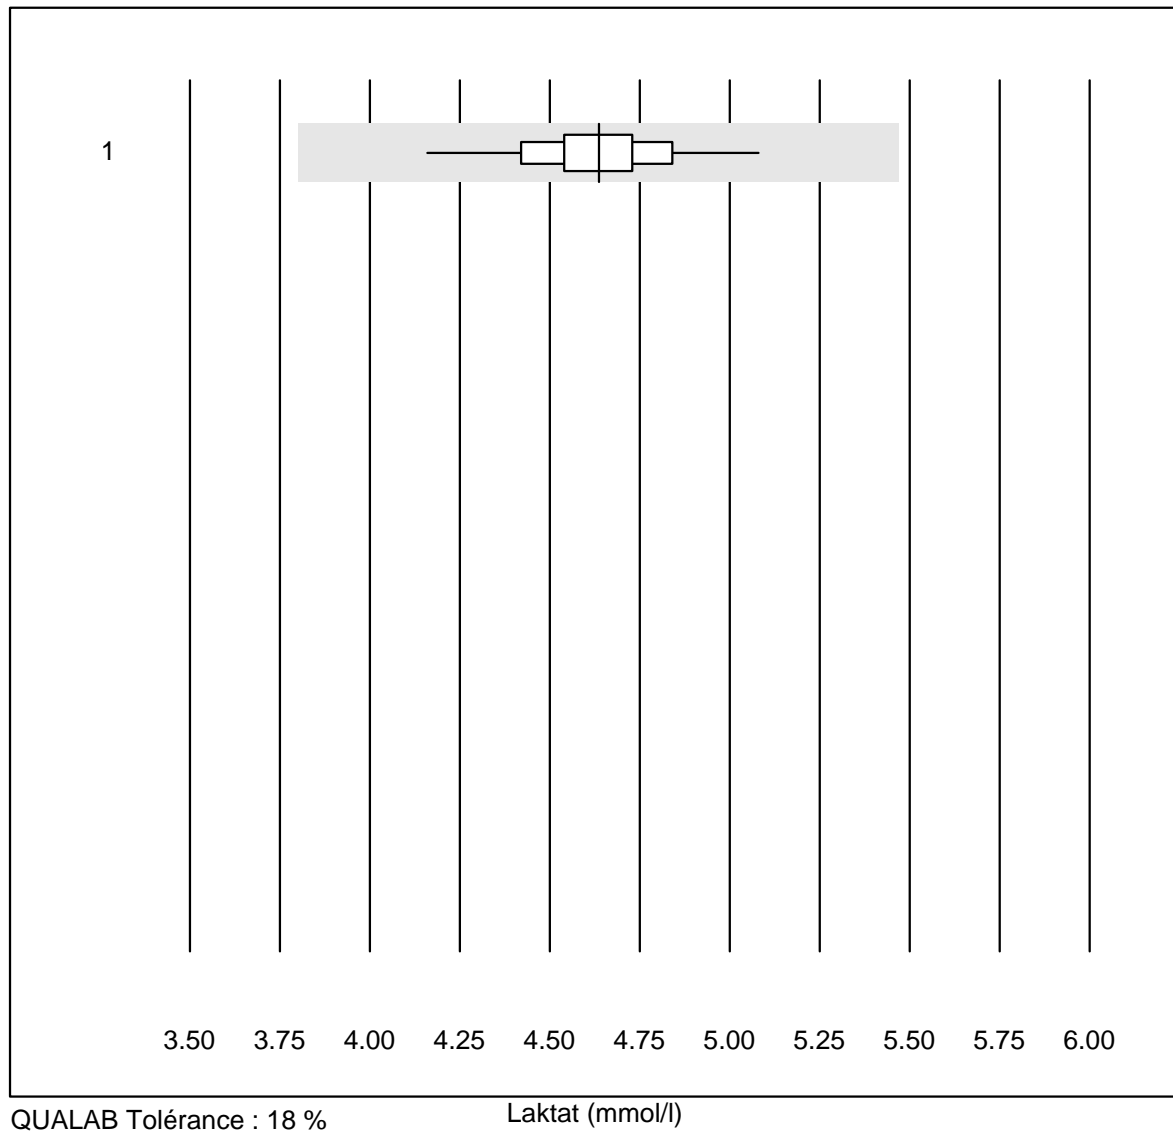

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	14	100.0	0.0	0.0	4.64	4.5	e

HbA1c échantillon A

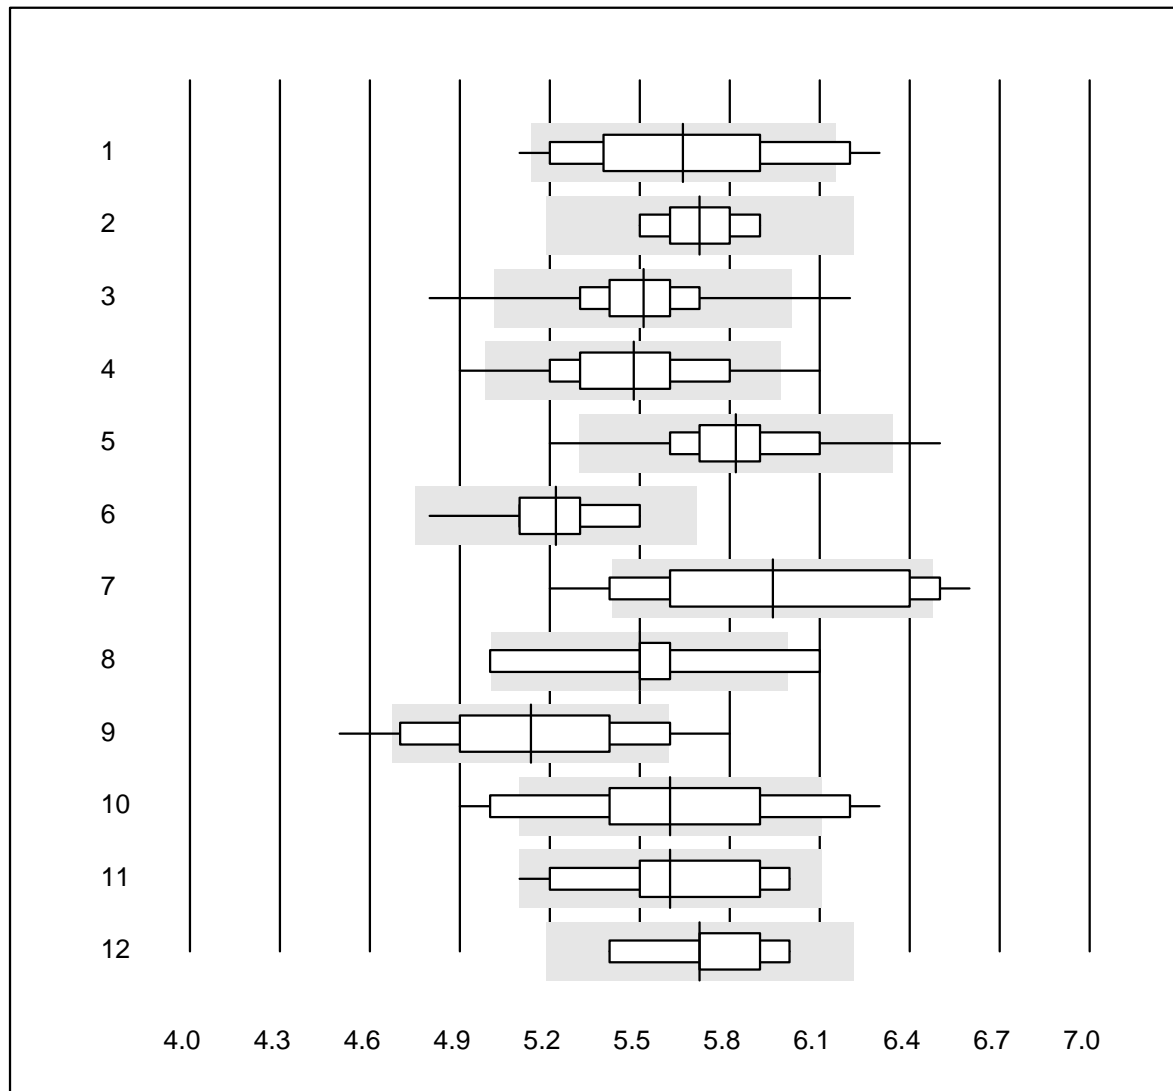


QUALAB Tolérance : 9 %

HbA1c échantillon A (%)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Roche, Cobas	18	83.3	16.7	0.0	5.6	6.0	e*
2 HPLC	7	100.0	0.0	0.0	5.7	2.3	e
3 Afinion	537	98.5	0.9	0.6	5.5	2.7	e
4 Cobas b101	137	95.7	3.6	0.7	5.5	4.4	e
5 DCA2000/Vantage	146	95.2	2.1	2.7	5.8	3.5	e
6 Celltac chemi	21	95.2	0.0	4.8	5.2	3.4	e
7 NycoCard	18	77.8	22.2	0.0	5.9	7.0	e*
8 Eurolyser	9	77.8	22.2	0.0	5.5	5.2	e*
9 A1c Now	211	76.8	15.6	7.6	5.1	6.1	e
10 AFIAS	59	69.5	25.4	5.1	5.6	6.9	e
11 Andere	20	90.0	0.0	10.0	5.6	4.5	e
12 Spinit	9	100.0	0.0	0.0	5.7	3.4	e*

HbA1c échantillon B

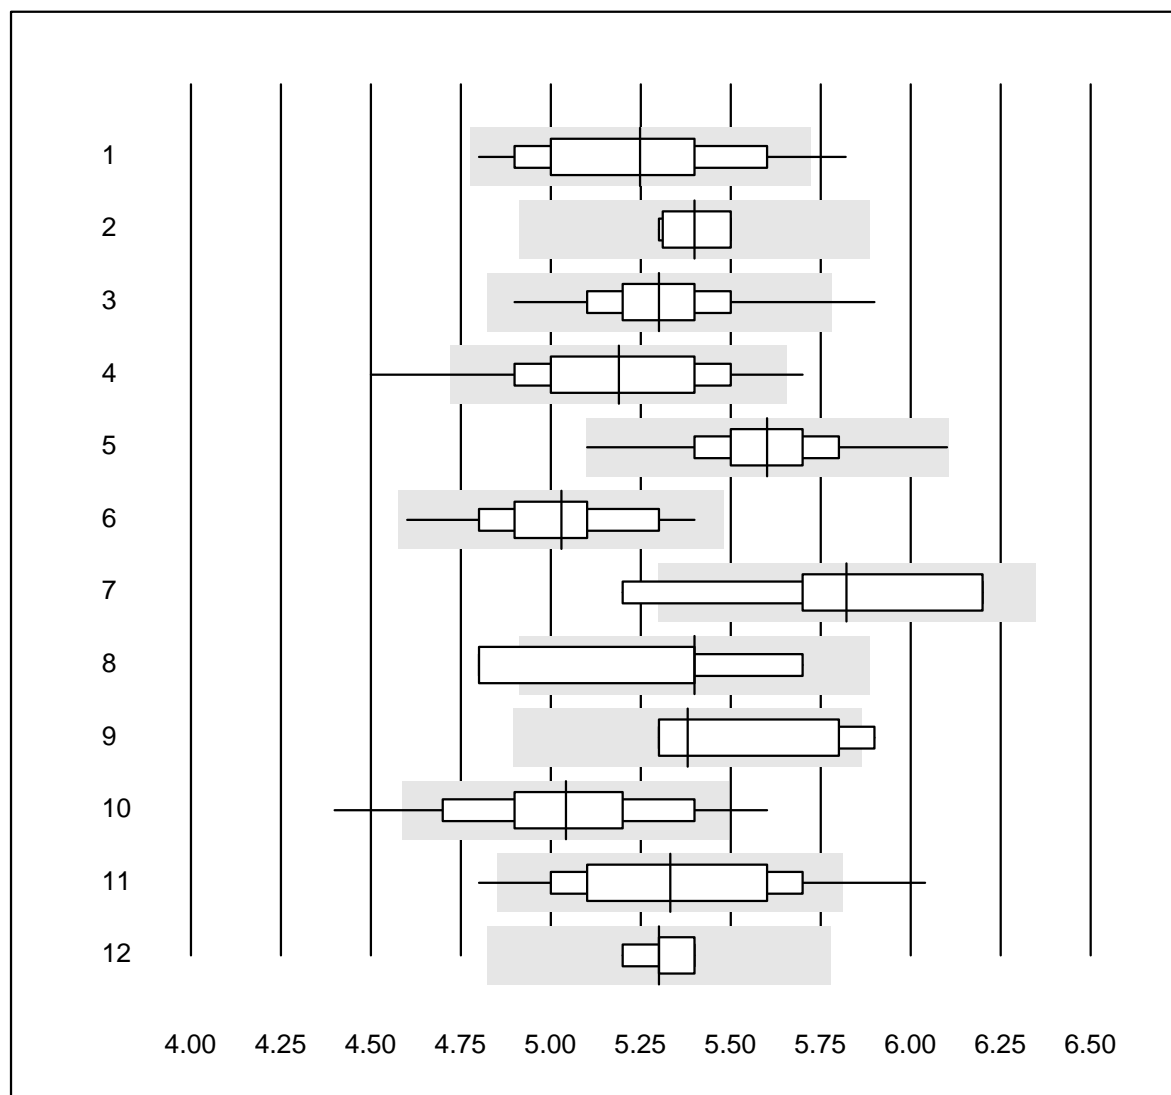


QUALAB Tolérance : 9 %

HbA1c échantillon B (%)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Roche, Cobas	17	88.2	5.9	5.9	5.2	5.5	e*
2 HPLC	7	100.0	0.0	0.0	5.4	1.5	e
3 Afinion	800	98.7	0.5	0.8	5.3	2.5	e
4 Cobas b101	158	93.7	5.7	0.6	5.2	4.5	e
5 DCA2000/Vantage	228	100.0	0.0	0.0	5.6	3.1	e
6 Celltac chemi	15	93.3	0.0	6.7	5.0	4.2	e*
7 NycoCard	10	70.0	20.0	10.0	5.8	6.9	e*
8 Eurolyser	8	75.0	25.0	0.0	5.4	6.3	e*
9 Hemocue HbA1c 501	4	75.0	25.0	0.0	5.4	4.9	a
10 A1c Now	18	83.3	11.1	5.6	5.0	5.7	e*
11 AFIAS	89	82.0	10.1	7.9	5.3	6.0	e
12 Spinit	7	100.0	0.0	0.0	5.3	1.3	e
13 Andere	17	94.1	5.9	0.0	5.4	5.1	e*

pCO2

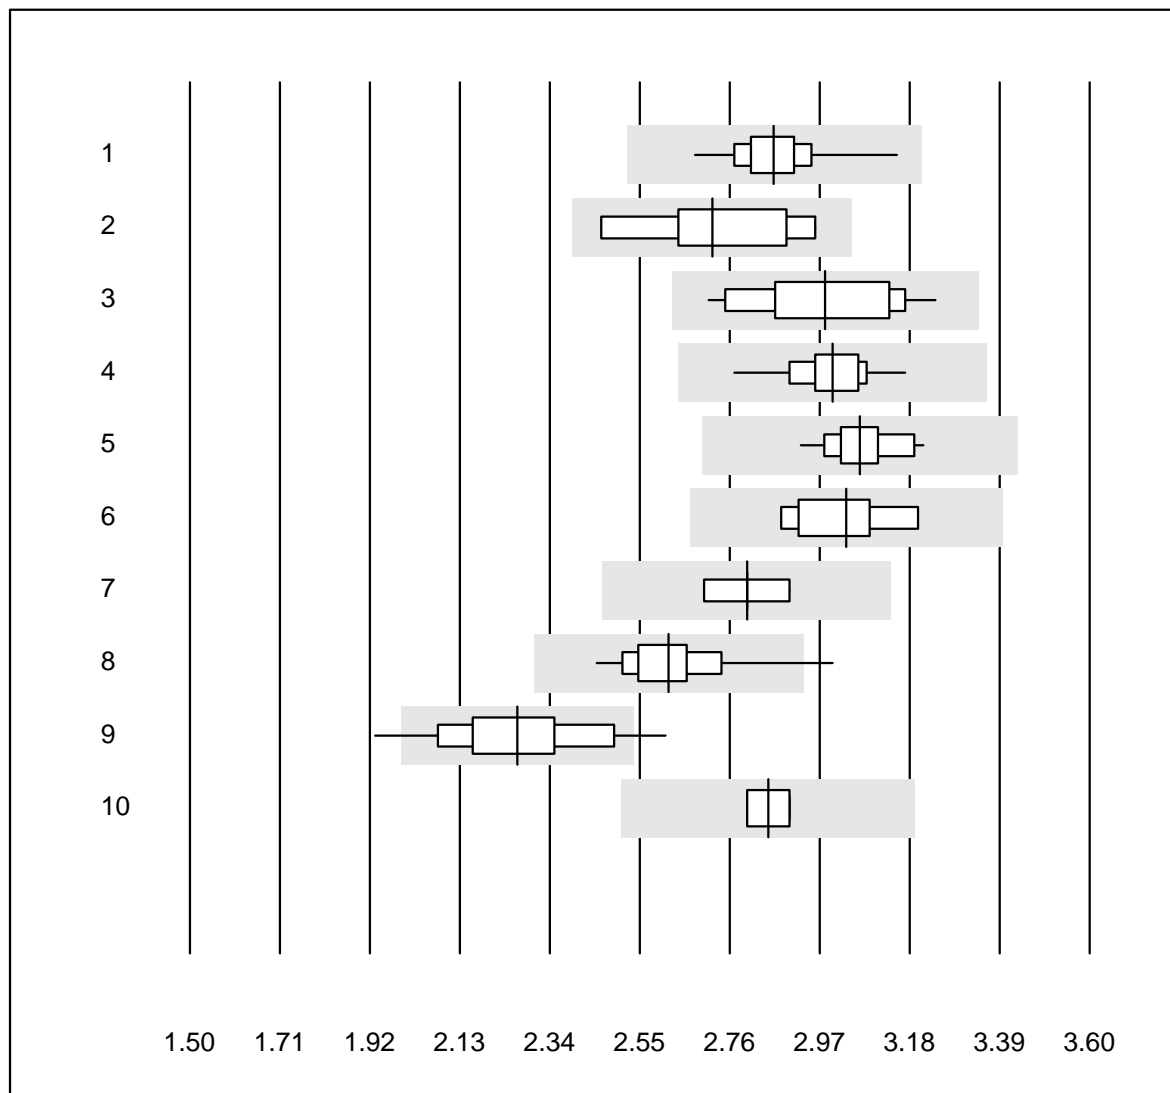


QUALAB Tolérance : 12 %

pCO2 (kPa)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	ABL700/800	94	100.0	0.0	0.0	2.86	2.6	e
2	ABL80 FLEX	7	100.0	0.0	0.0	2.72	6.0	e*
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	14	100.0	0.0	0.0	2.98	5.4	e
4	ABL90 FLEX / PLUS	78	100.0	0.0	0.0	3.00	2.4	e
5	Cobas b 123	14	100.0	0.0	0.0	3.06	2.5	e
6	Cobas b 221	7	100.0	0.0	0.0	3.03	3.6	e
7	GEM	5	100.0	0.0	0.0	2.80	2.5	e
8	iStat	40	95.0	2.5	2.5	2.62	3.8	e
9	EPOC	51	92.2	3.9	3.9	2.26	6.5	e
10	IL	4	100.0	0.0	0.0	2.85	2.0	e

pO2

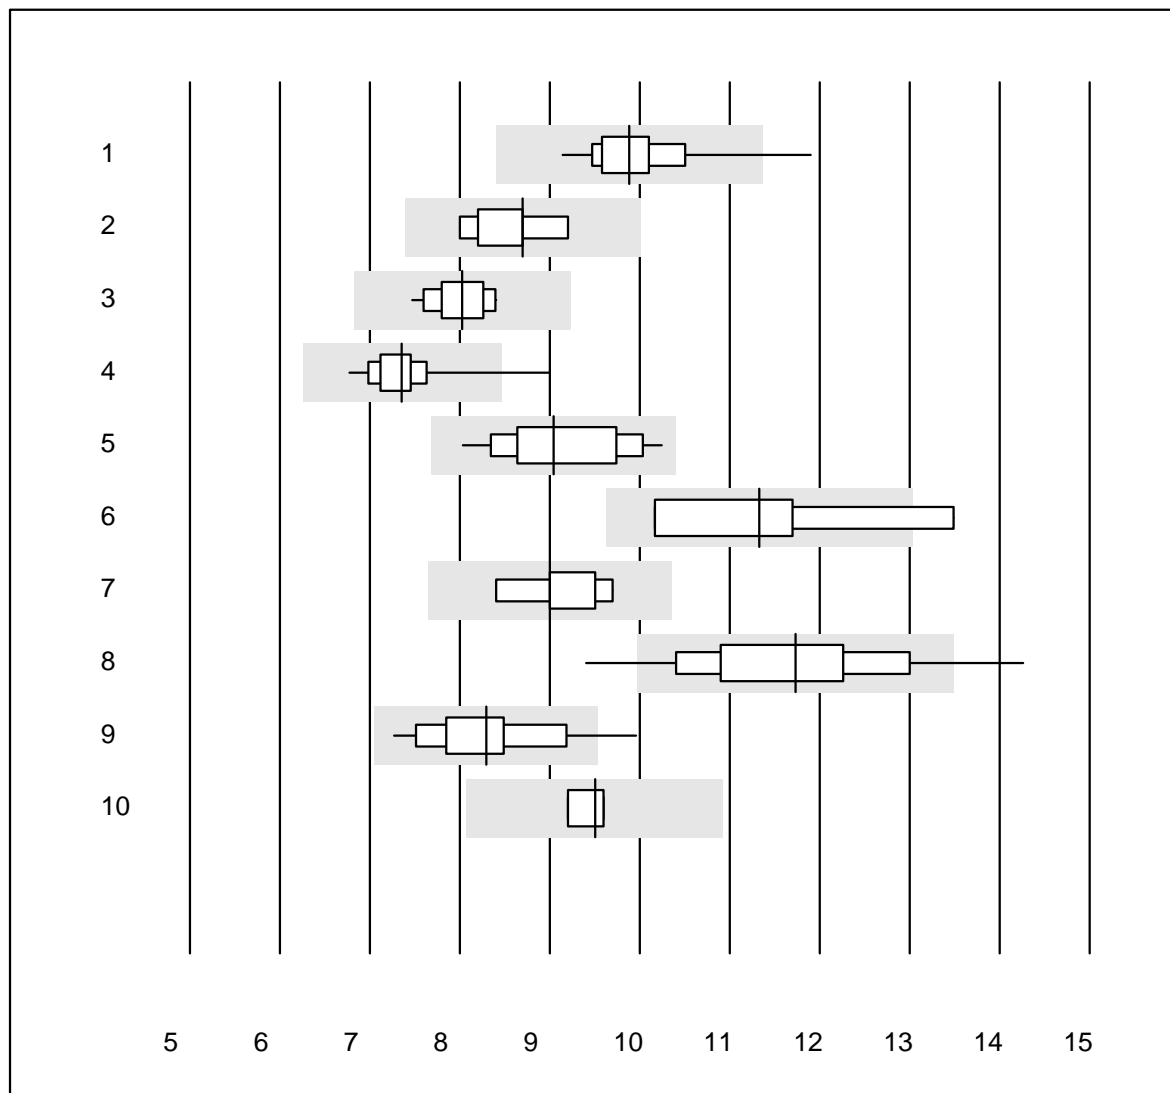


QUALAB Tolérance : 15 %

pO2 (kPa)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 ABL700/800	93	97.8	1.1	1.1	9.88	4.5	e
2 ABL80 FLEX	7	71.4	0.0	28.6	8.70	5.5	e*
3 ABL80 FLEX CO-OX / O	14	78.6	0.0	21.4	8.03	3.8	e
4 ABL90 FLEX / PLUS	79	83.5	5.1	11.4	7.36	5.8	e
5 Cobas b 123	14	100.0	0.0	0.0	9.04	7.4	e*
6 Cobas b 221	7	42.8	14.3	42.9	11.33	11.8	e*
7 GEM	5	100.0	0.0	0.0	9.00	5.6	e*
8 iStat	38	76.3	7.9	15.8	11.73	9.2	e
9 EPOC	51	76.4	2.0	21.6	8.29	7.4	e
10 IL	4	100.0	0.0	0.0	9.50	2.0	e

pH

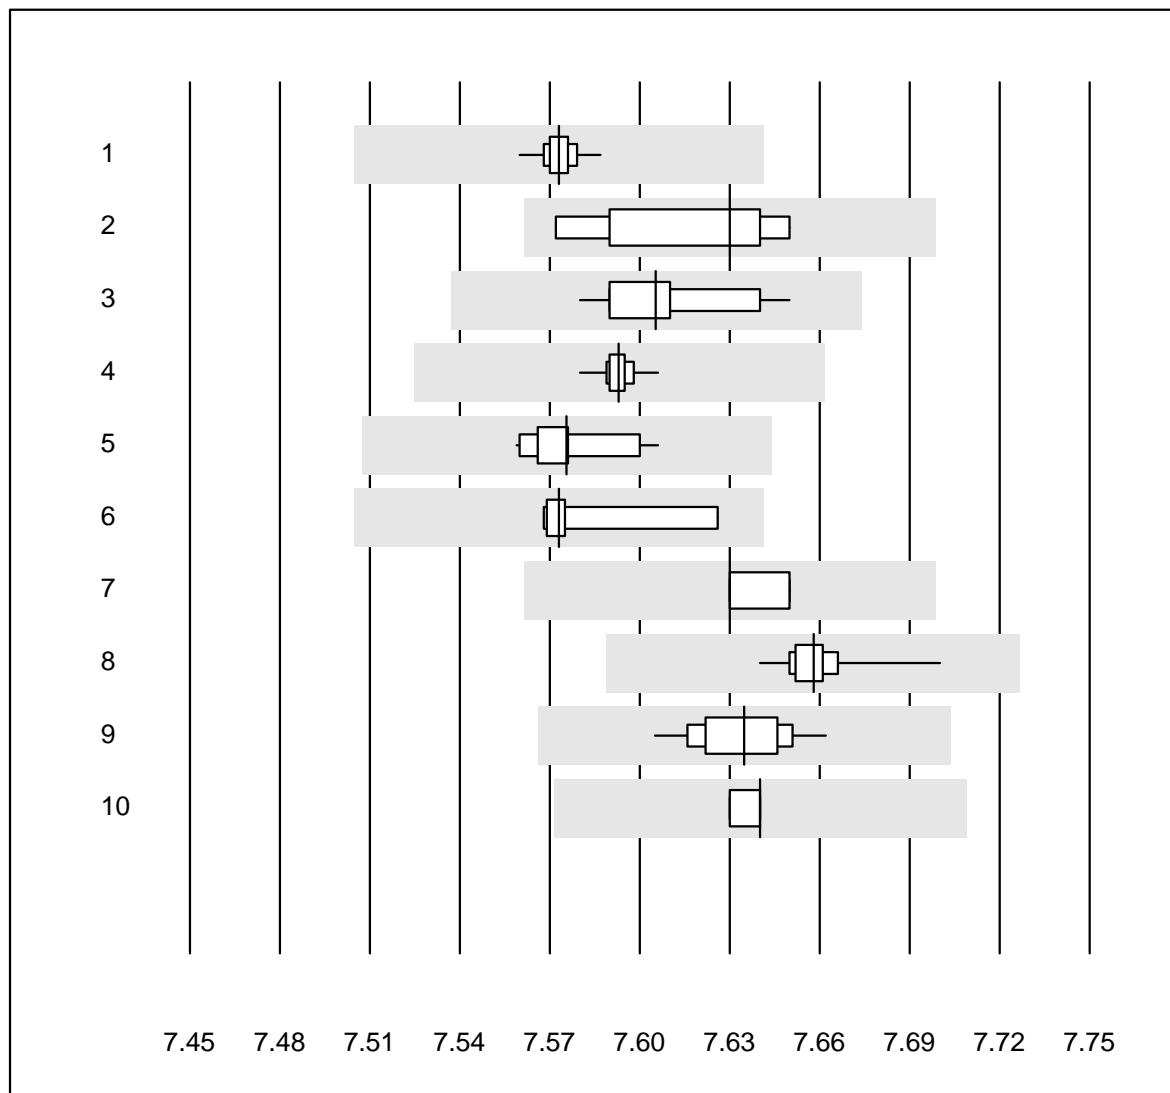


QUALAB Tolérance : 1 %

pH ()

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	ABL700/800	93	100.0	0.0	0.0	7.57	0.1	e
2	ABL80 FLEX	8	100.0	0.0	0.0	7.63	0.4	e*
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	13	100.0	0.0	0.0	7.61	0.3	e
4	ABL90 FLEX / PLUS	79	98.7	0.0	1.3	7.59	0.1	e
5	Cobas b 123	14	100.0	0.0	0.0	7.58	0.2	e
6	Cobas b 221	7	100.0	0.0	0.0	7.57	0.3	e
7	GEM	5	100.0	0.0	0.0	7.63	0.1	e
8	iStat	41	100.0	0.0	0.0	7.66	0.1	e
9	EPOC	50	100.0	0.0	0.0	7.63	0.2	e
10	IL	4	100.0	0.0	0.0	7.64	0.1	e

Glucose GS

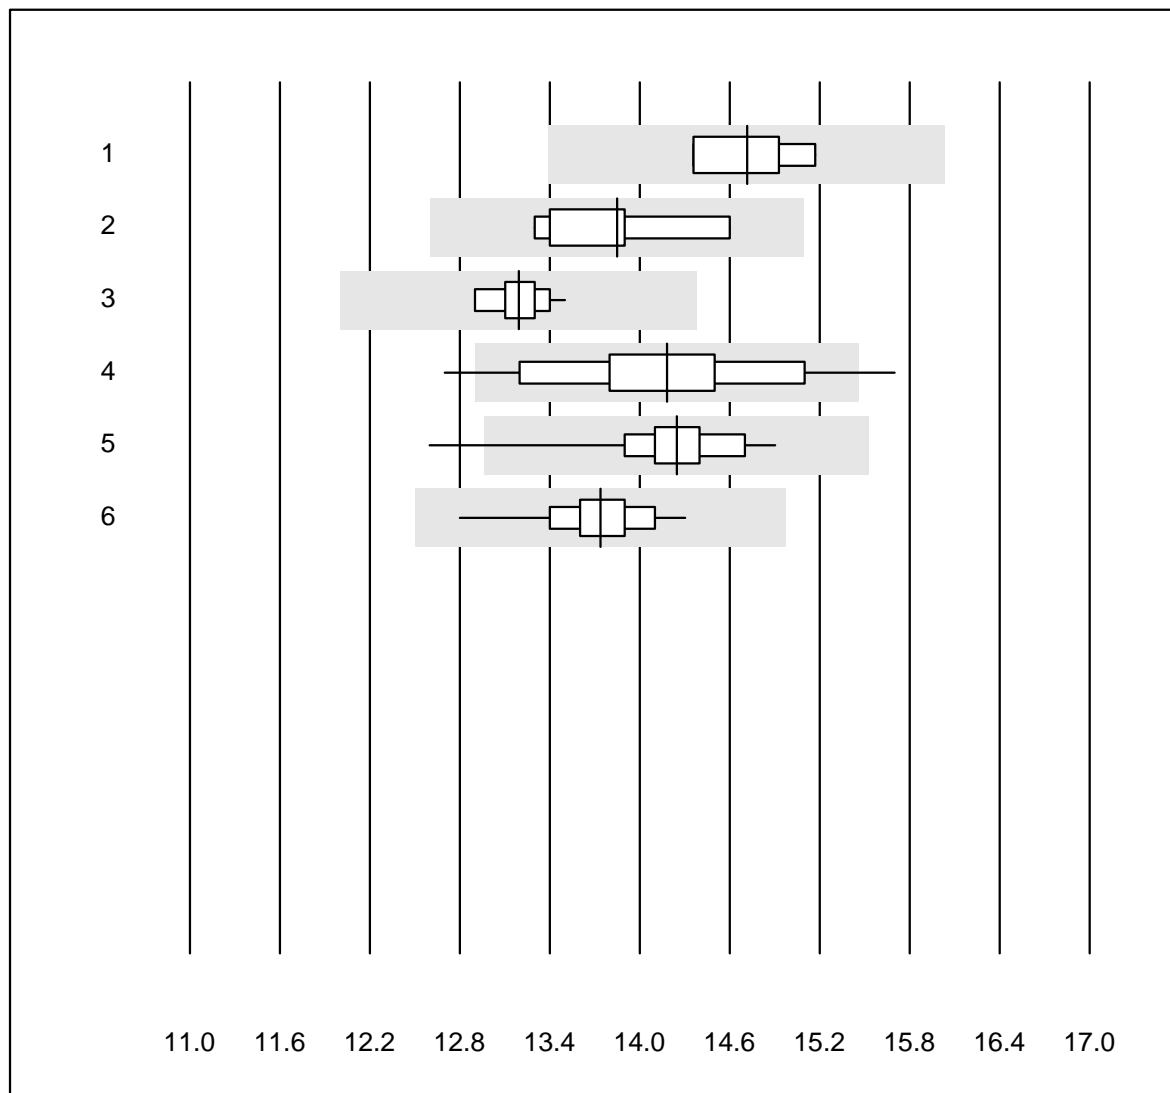


QUALAB Tolérance : 9 %

Glucose GS (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas b 221	4	100.0	0.0	0.0	14.7	2.5	e*
2 Cobas b 123	8	100.0	0.0	0.0	13.9	3.2	e*
3 iStat	11	100.0	0.0	0.0	13.2	1.4	e
4 EPOC	38	89.5	10.5	0.0	14.2	4.9	e
5 ABL700/800	85	98.8	1.2	0.0	14.2	2.3	e
6 ABL90 FLEX / PLUS	77	100.0	0.0	0.0	13.7	2.1	e

Hémoglobine BG

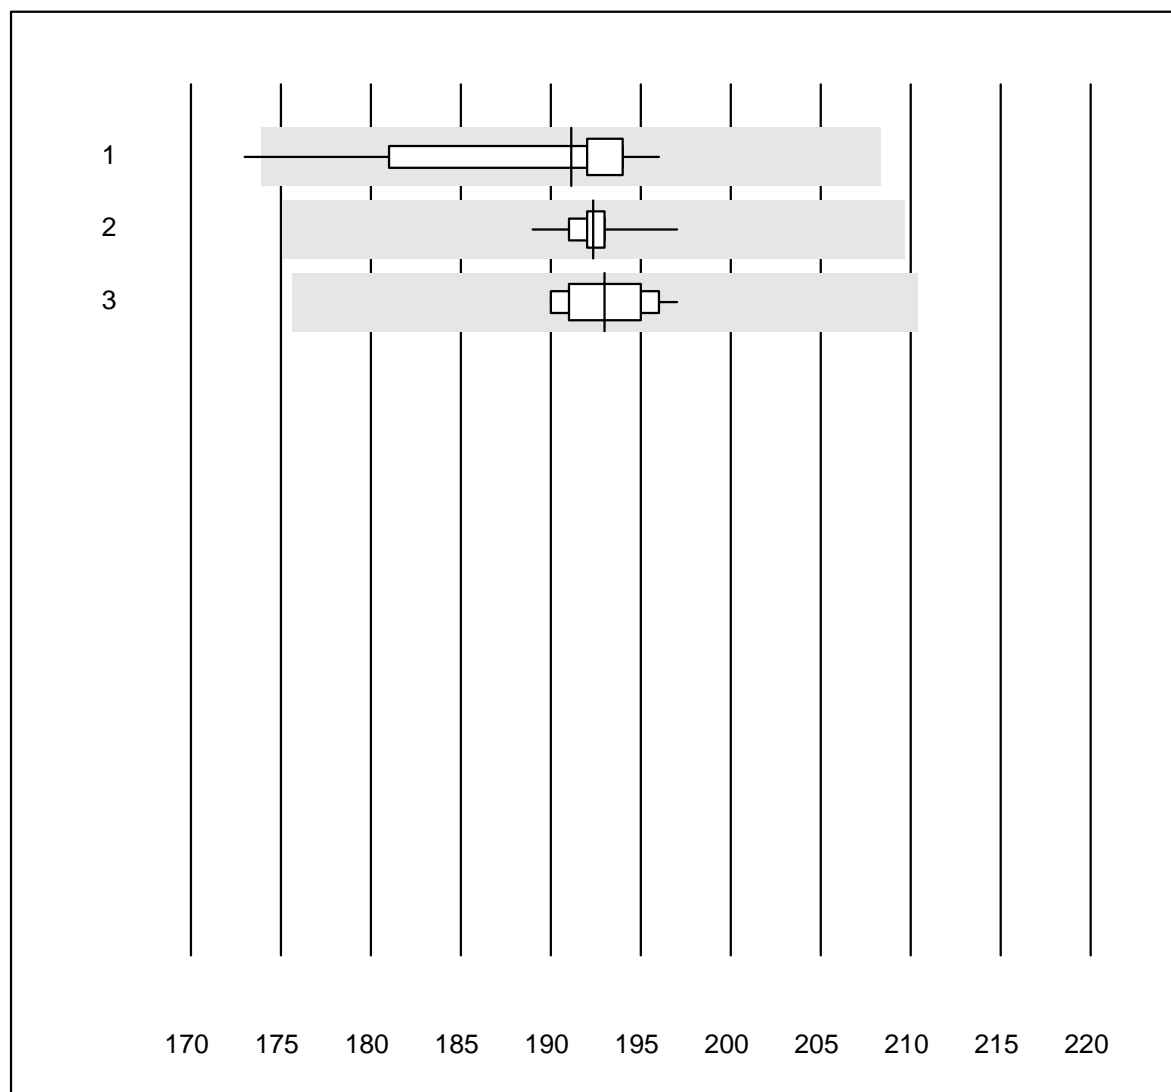


QUALAB Tolérance : 9 %

Hémoglobine BG (g/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 ABL700/800	86	98.8	1.2	0.0	191.1	2.6	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	73	98.6	0.0	1.4	192.3	0.6	e
3 ABL80 FLEX CO-OX / O	10	100.0	0.0	0.0	193.0	1.3	e

Potassium BG

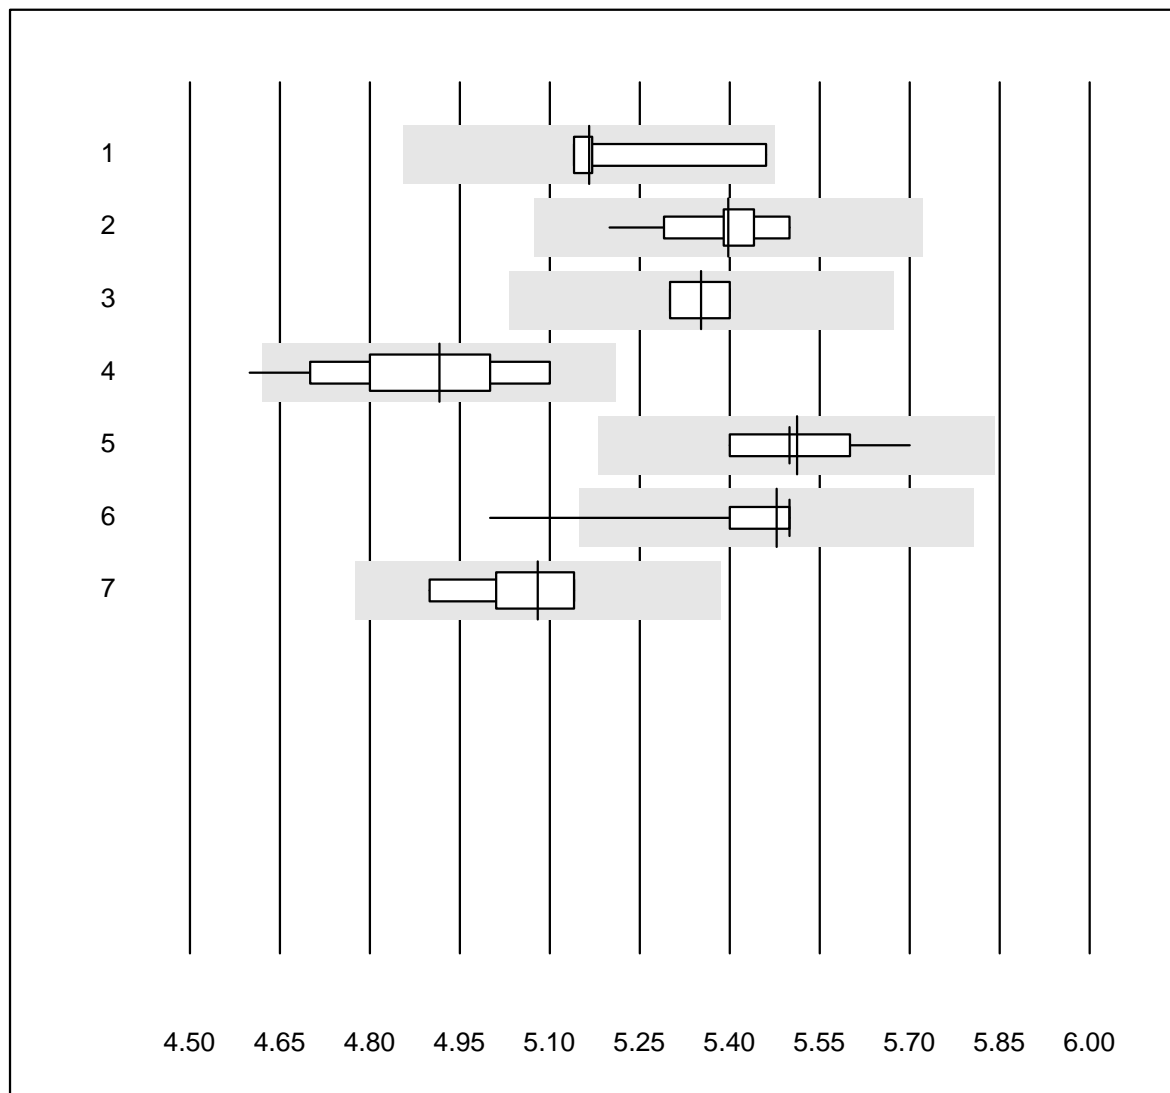


QUALAB Tolérance : 6 %

Potassium BG (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	ABL80 FLEX	4	100.0	0.0	0.0	5.2	2.9	e*
2	Cobas b 123	19	100.0	0.0	0.0	5.4	1.2	e
3	iStat	19	100.0	0.0	0.0	5.4	1.0	e
4	EPOC	43	97.7	2.3	0.0	4.9	2.6	e
5	ABL700/800	86	100.0	0.0	0.0	5.5	1.3	e
6	ABL90 FLEX / PLUS	79	98.7	1.3	0.0	5.5	1.2	e
7	ABL80 FLEX CO-OX / O	6	100.0	0.0	0.0	5.1	1.8	e*

Sodium BG

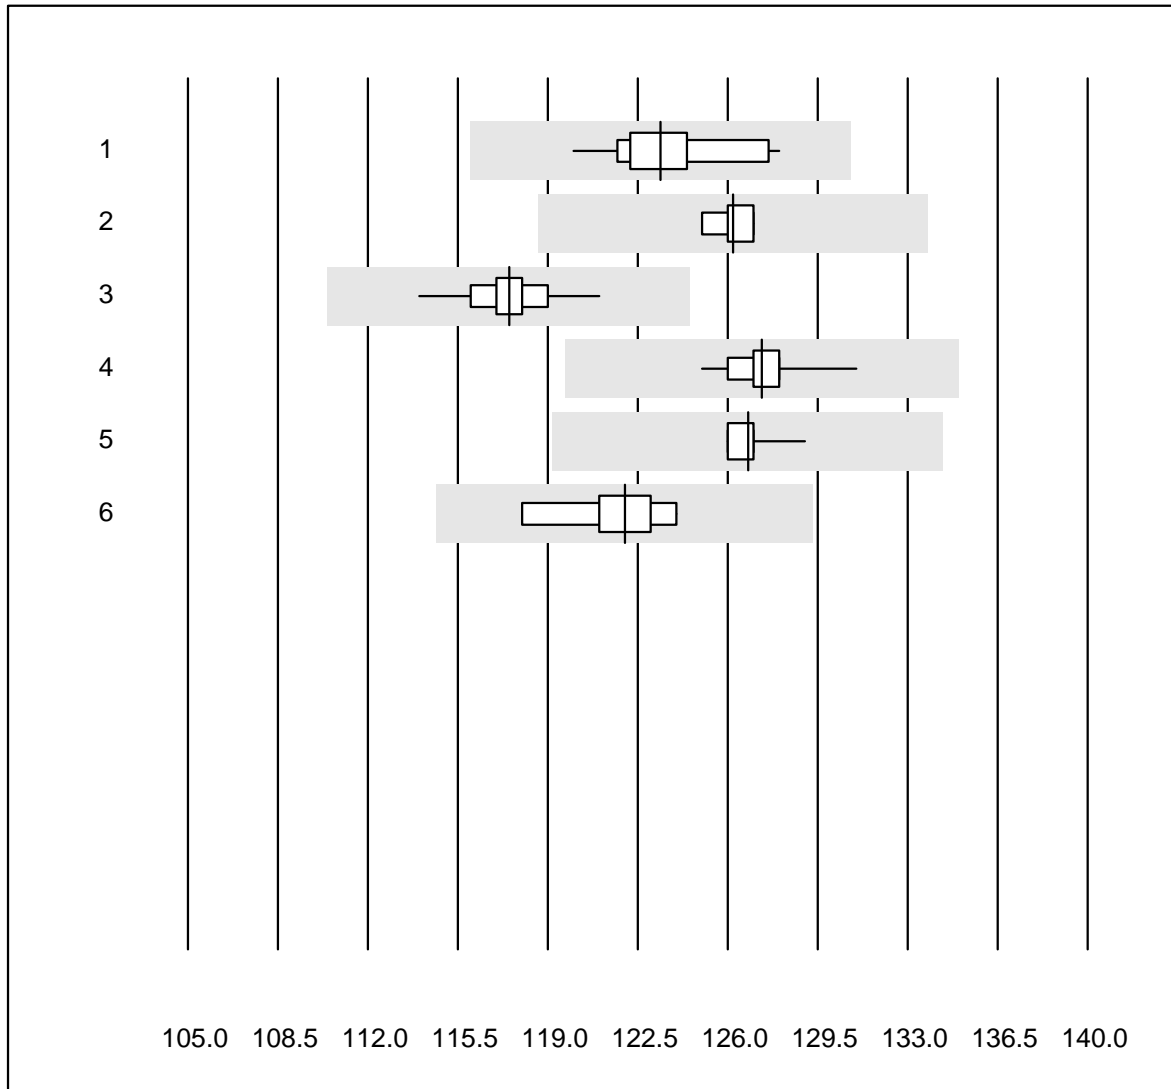


QUALAB Tolérance : 6 %

Sodium BG (mmol/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas b 123	19	100.0	0.0	0.0	123.4	1.6	e
2 iStat	19	100.0	0.0	0.0	126.2	0.5	e
3 EPOC	41	100.0	0.0	0.0	117.5	1.1	e
4 ABL700/800	84	100.0	0.0	0.0	127.3	0.8	e
5 ABL90 FLEX / PLUS	78	100.0	0.0	0.0	126.8	0.4	e
6 ABL80 FLEX CO-OX / O	6	100.0	0.0	0.0	122.0	1.7	e

Chlorure-BG

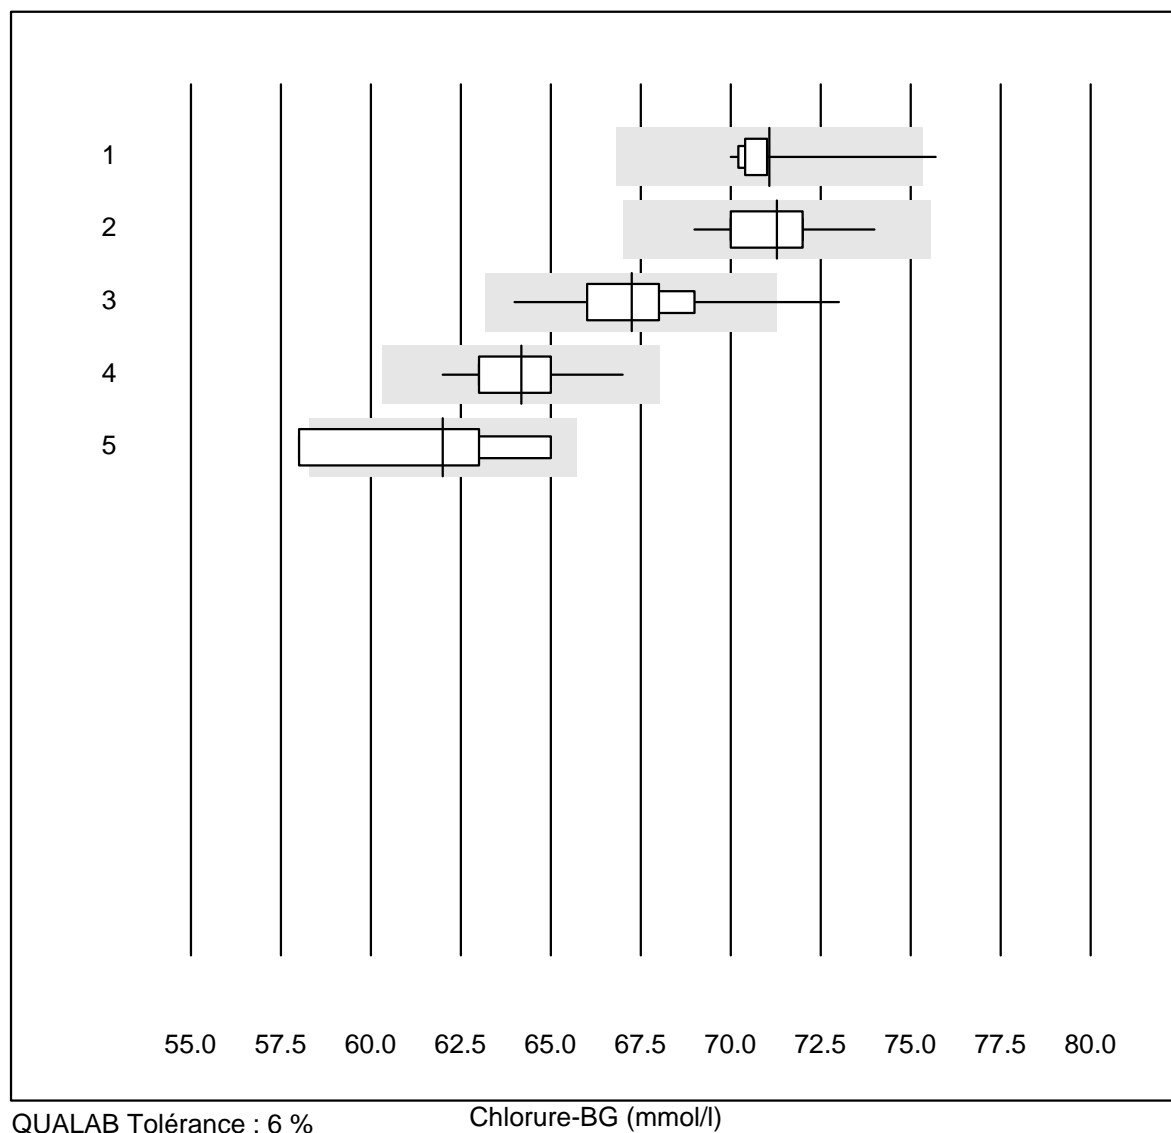

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas b 123	11	90.9	9.1	0.0	71.1	2.2	e
2 EPOC	11	100.0	0.0	0.0	71.3	1.9	e
3 ABL700/800	80	98.7	1.3	0.0	67.2	2.1	e
4 ABL90 FLEX / PLUS	74	100.0	0.0	0.0	64.2	1.6	e
5 ABL80 FLEX CO-OX / O	4	75.0	25.0	0.0	62.0	4.8	e*

Calcium-BG

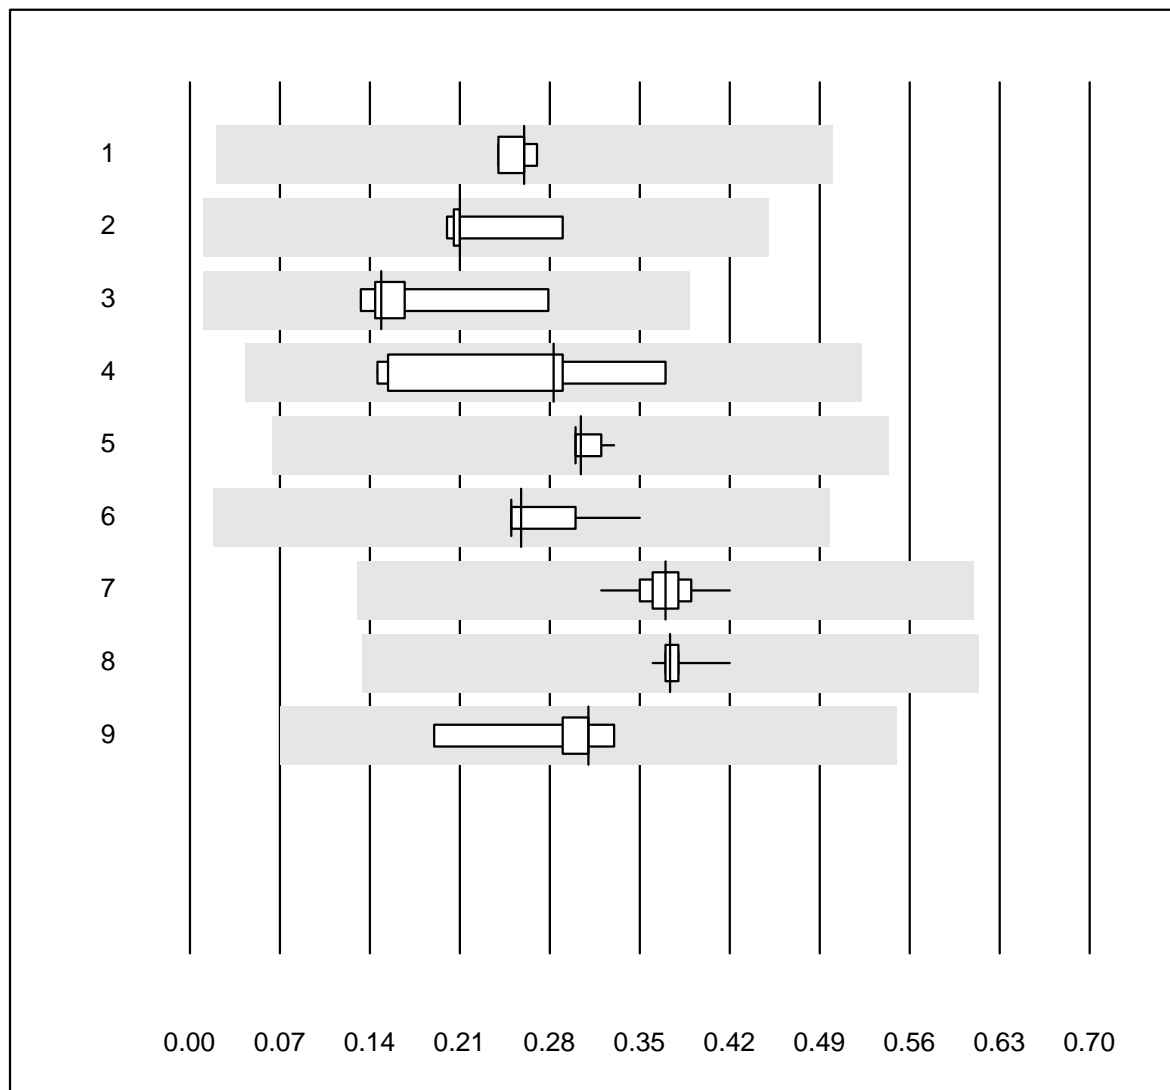


Tolérance MQ : 12 %
(< 2.00: +/- 0.24 mmol/l)

Calcium-BG (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	GEM	4	100.0	0.0	0.0	0.26	4.9	e*
2	ABL80 FLEX	5	100.0	0.0	0.0	0.21	16.9	e*
3	Cobas b123	9	100.0	0.0	0.0	0.15	27.3	e*
4	Cobas	7	100.0	0.0	0.0	0.28	31.2	e*
5	iStat	12	100.0	0.0	0.0	0.30	3.3	e
6	EPOC	39	100.0	0.0	0.0	0.26	9.1	e*
7	ABL700/800	86	100.0	0.0	0.0	0.37	4.9	e
8	ABL90 FLEX / PLUS	77	100.0	0.0	0.0	0.37	2.1	e
9	ABL80 FLEX CO-OX / O	5	100.0	0.0	0.0	0.31	19.4	e*

FHHb

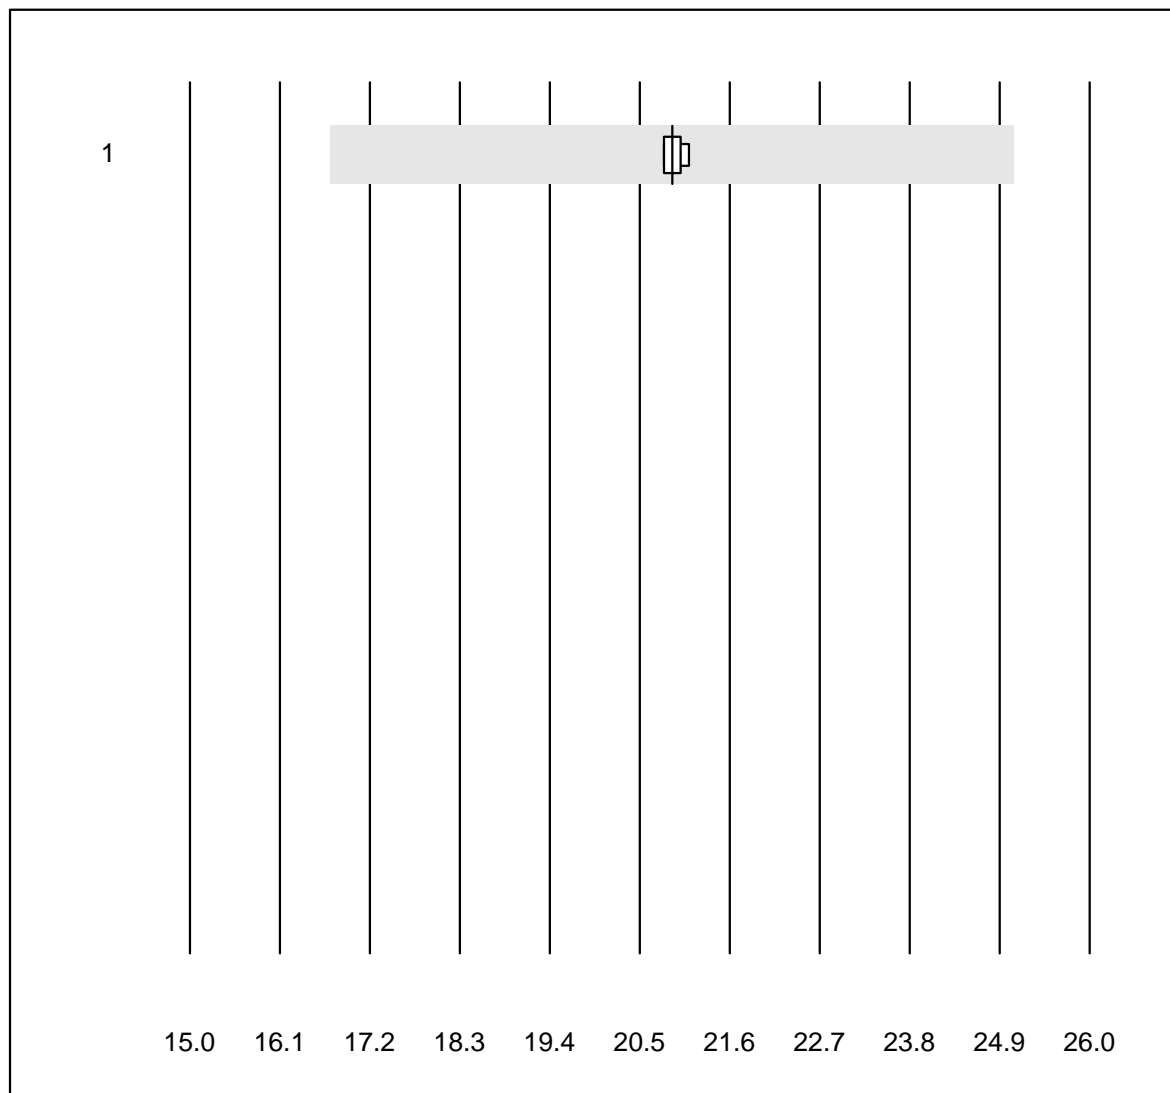


Tolérance MQ : 20 %

FHHb (%)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	ABL80 FLEX CO-OX / O	6	100.0	0.0	0.0	20.900	0.6	e

Lactate-BG

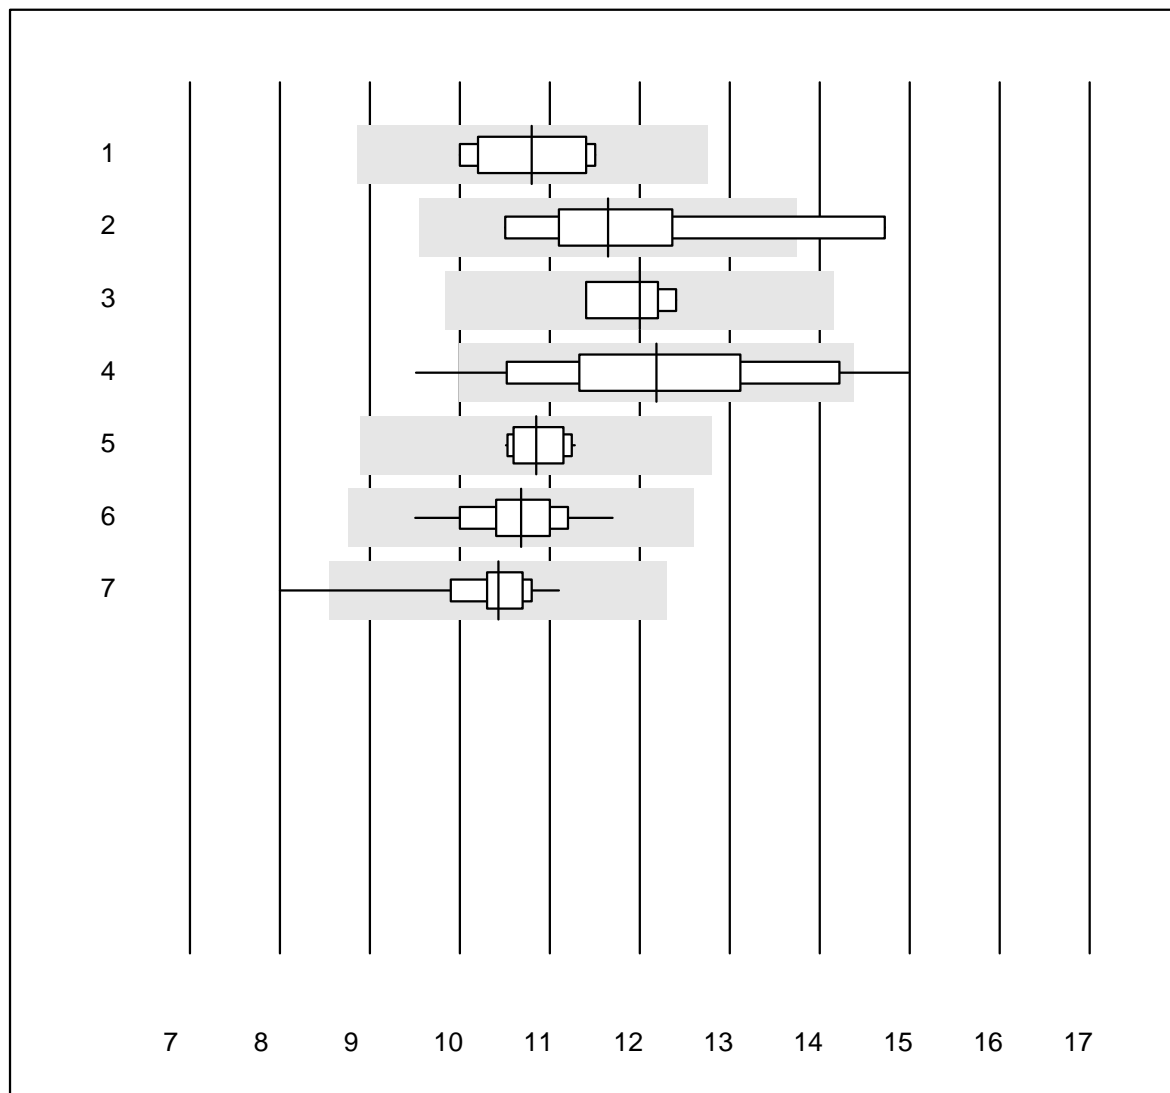


QUALAB Tolérance : 18 %

Lactate-BG (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	Cobas b123	7	100.0	0.0	0.0	10.80	5.5	e
2	Cobas	6	83.3	16.7	0.0	11.65	12.4	e*
3	IL	4	100.0	0.0	0.0	12.00	3.7	e
4	EPOC	40	87.5	10.0	2.5	12.18	10.8	e
5	iStat	14	100.0	0.0	0.0	10.85	2.7	e
6	ABL700/800	91	100.0	0.0	0.0	10.68	4.1	e
7	ABL90 FLEX / PLUS	79	98.7	1.3	0.0	10.43	4.3	e

sO2 OR

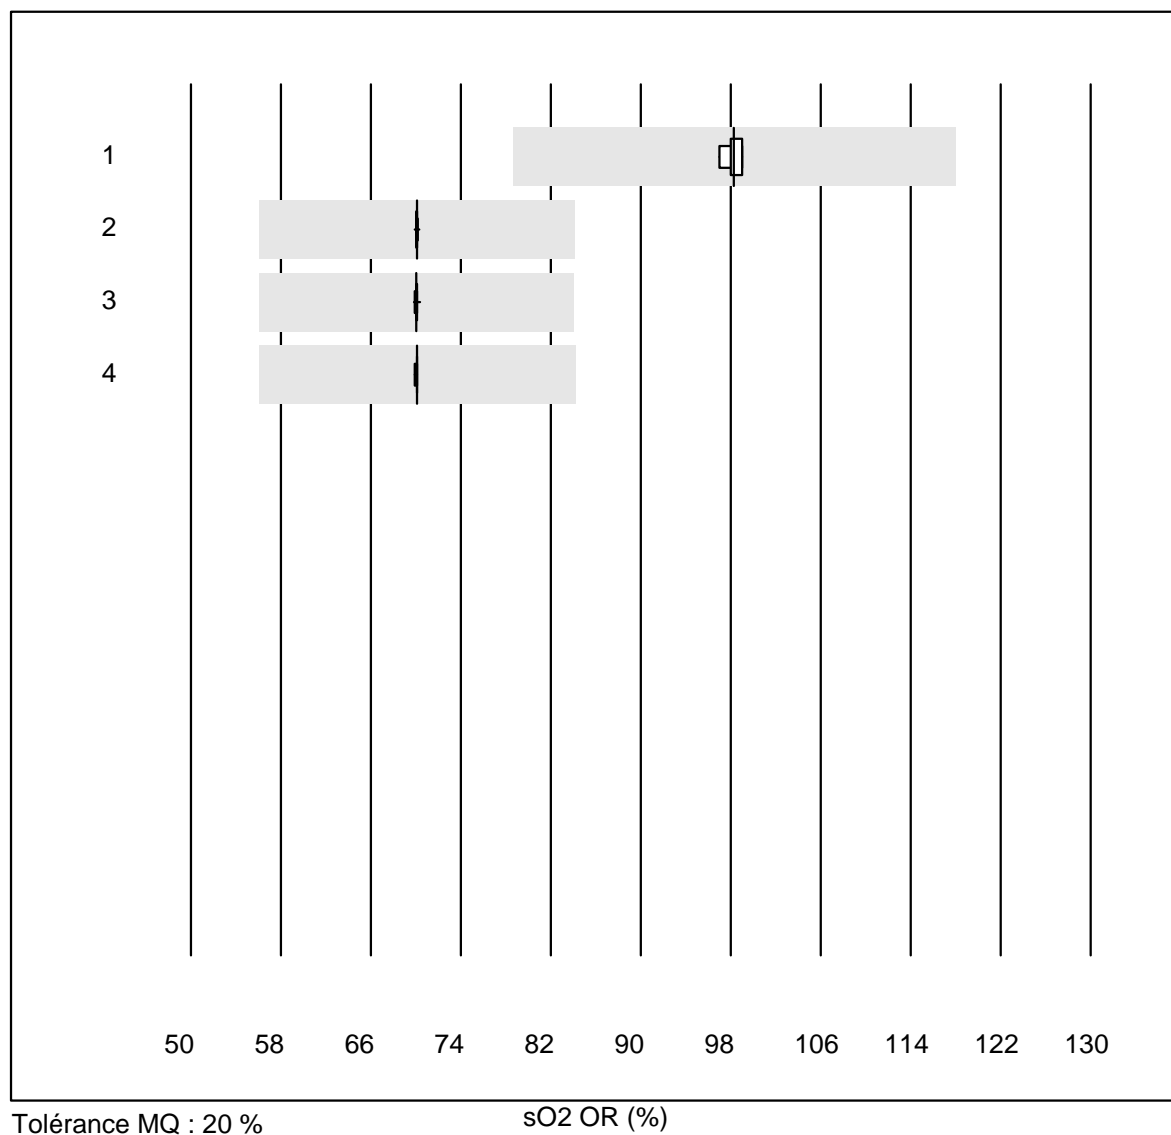


Tolérance MQ : 20 %

sO2 OR (%)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 iStat	10	100.0	0.0	0.0	98.300	0.7	e
2 ABL700/800	76	98.7	0.0	1.3	70.085	0.1	e
3 ABL90 FLEX / PLUS	69	100.0	0.0	0.0	70.022	0.1	e
4 ABL80 FLEX CO-OX / O	9	100.0	0.0	0.0	70.100	0.1	e

FO2Hb OR

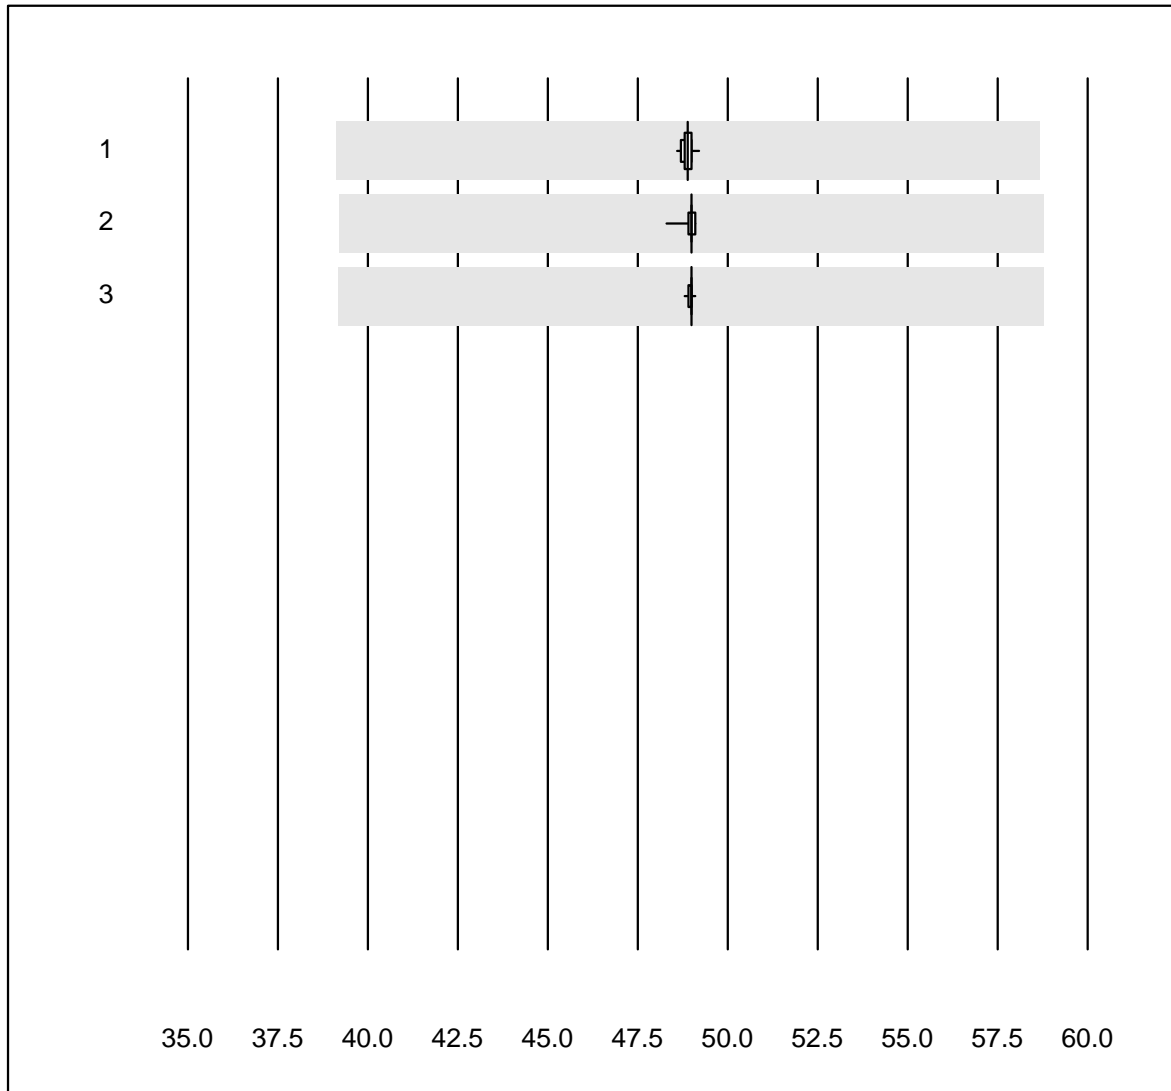


Tolérance MQ : 20 %

FO2Hb OR (%)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 ABL700/800	75	100.0	0.0	0.0	48.889	0.2	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	68	100.0	0.0	0.0	48.991	0.2	e
3 ABL80 FLEX CO-OX / O	11	100.0	0.0	0.0	48.982	0.2	e

FCOHb OR

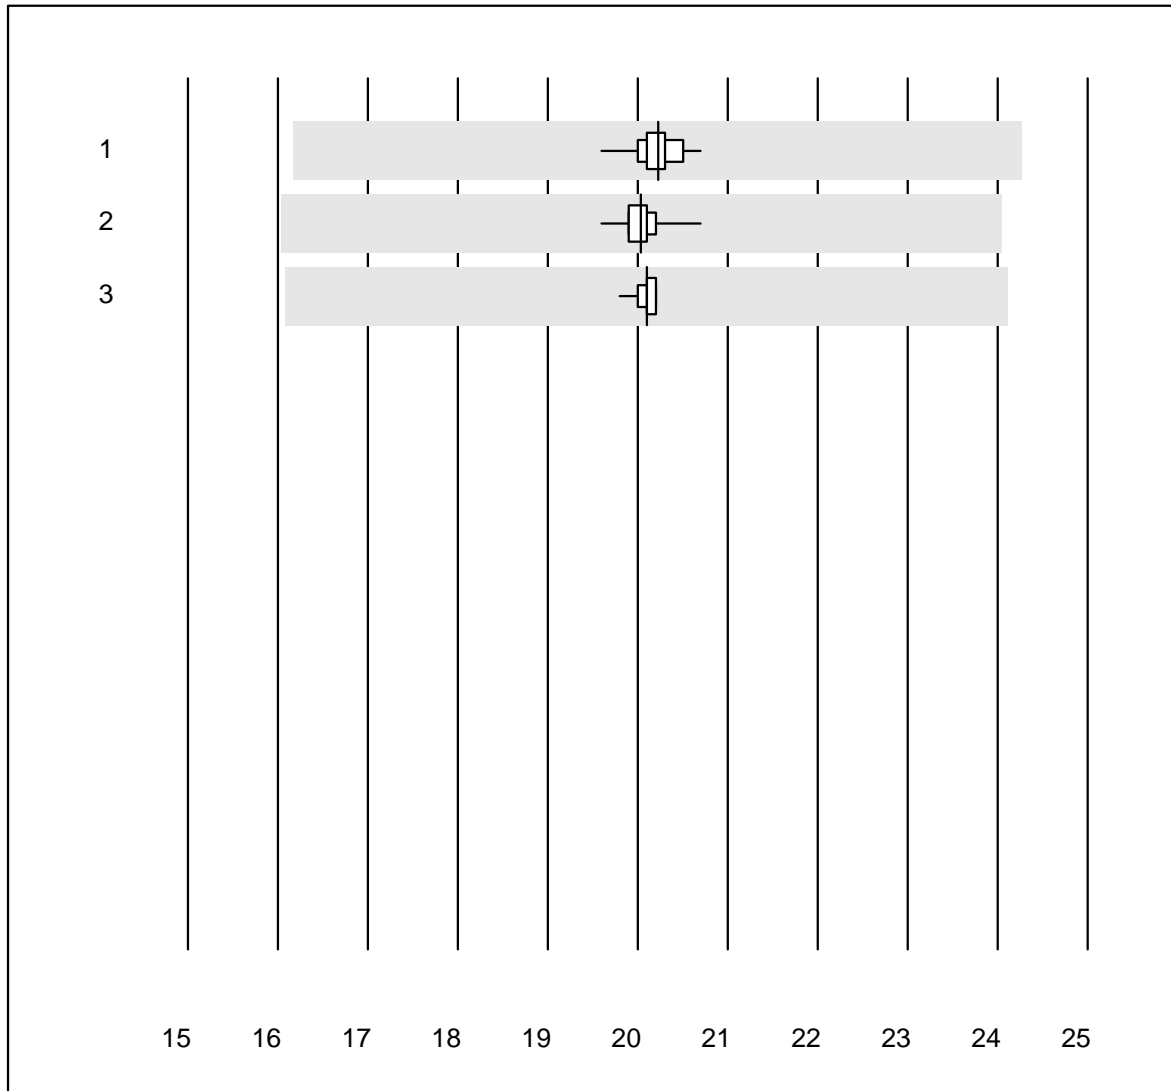


Tolérance MQ : 20 %

FCOHb OR (%)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 ABL700/800	77	98.7	0.0	1.3	20.224	1.0	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	67	100.0	0.0	0.0	20.037	0.8	e
3 ABL80 FLEX CO-OX / O	11	100.0	0.0	0.0	20.100	0.6	e

FMetHb OR

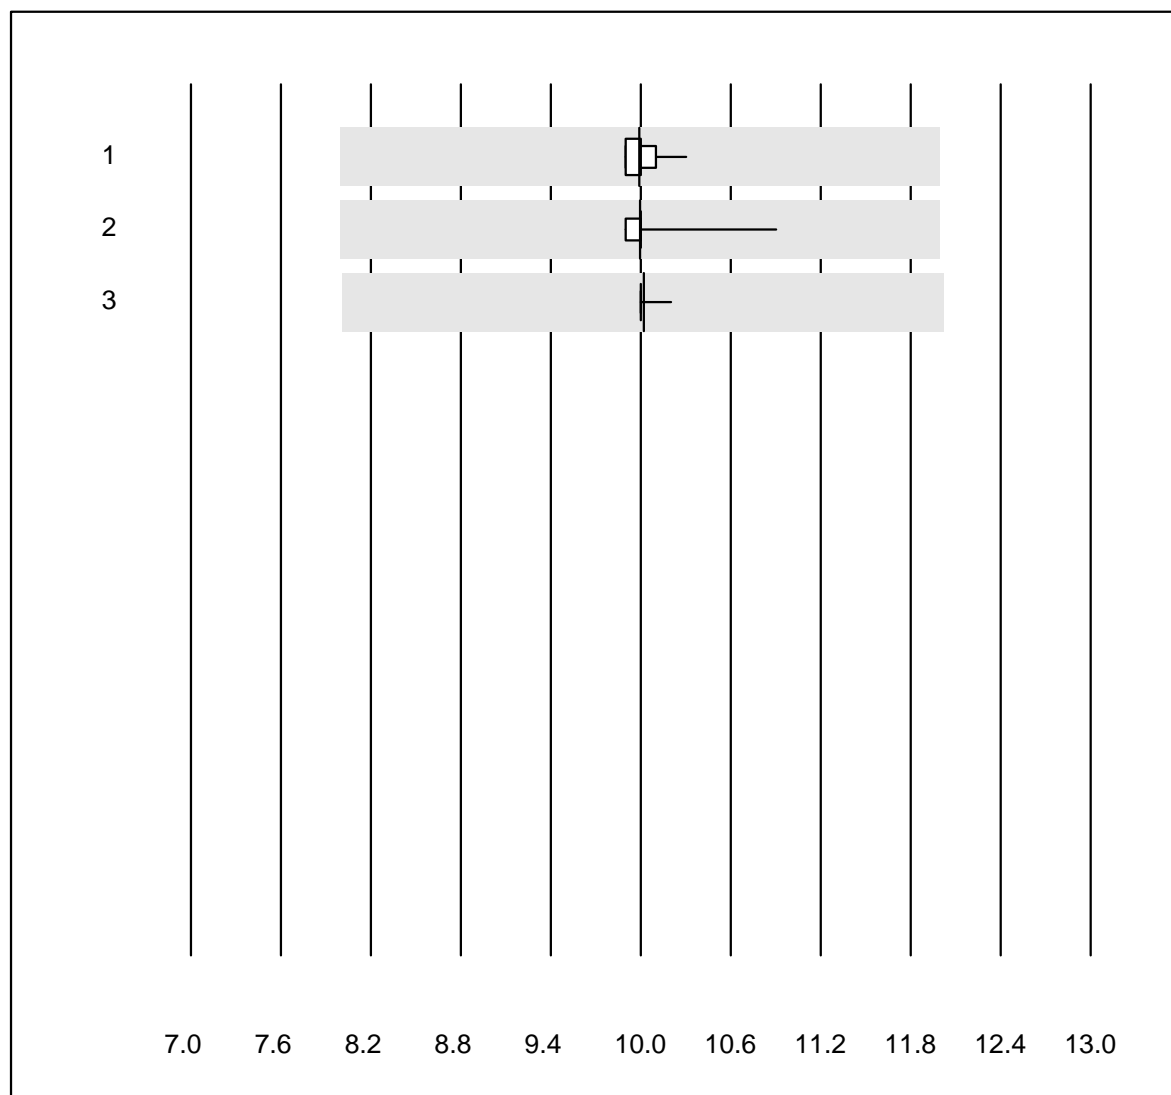


Tolérance MQ : 20 %

FMetHb OR (%)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 ABL700/800	77	100.0	0.0	0.0	9.992	0.8	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	67	98.5	0.0	1.5	9.997	1.2	e
3 ABL80 FLEX CO-OX / O	11	100.0	0.0	0.0	10.018	0.6	e

FHbF OR

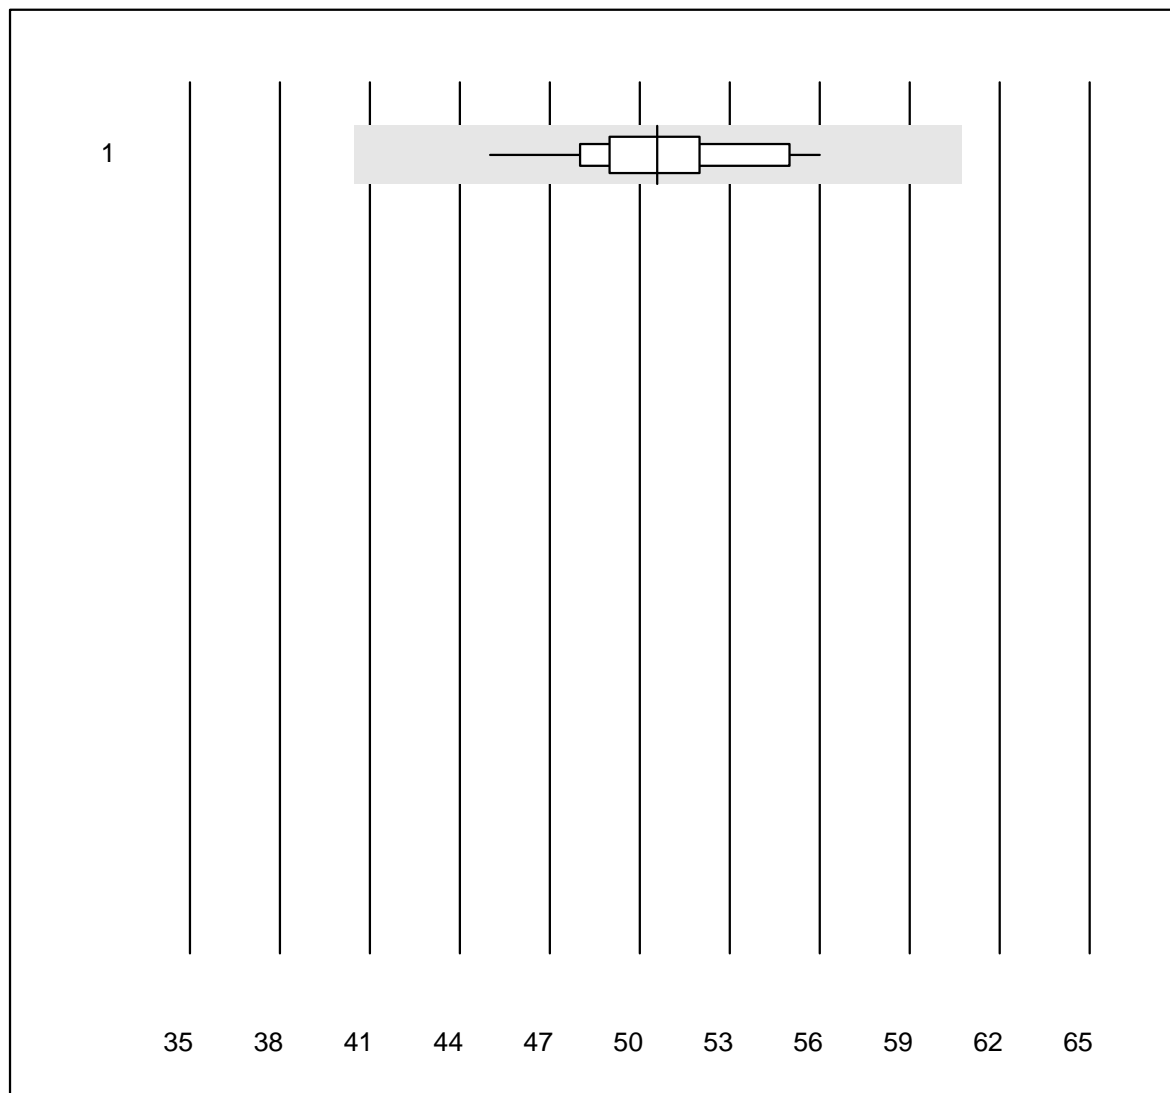


Tolérance MQ : 20 %

FHbF OR (%)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 ABL90 FLEX / PLUS	18	94.4	0.0	5.6	50.588	5.0	e

Bilirubin OR

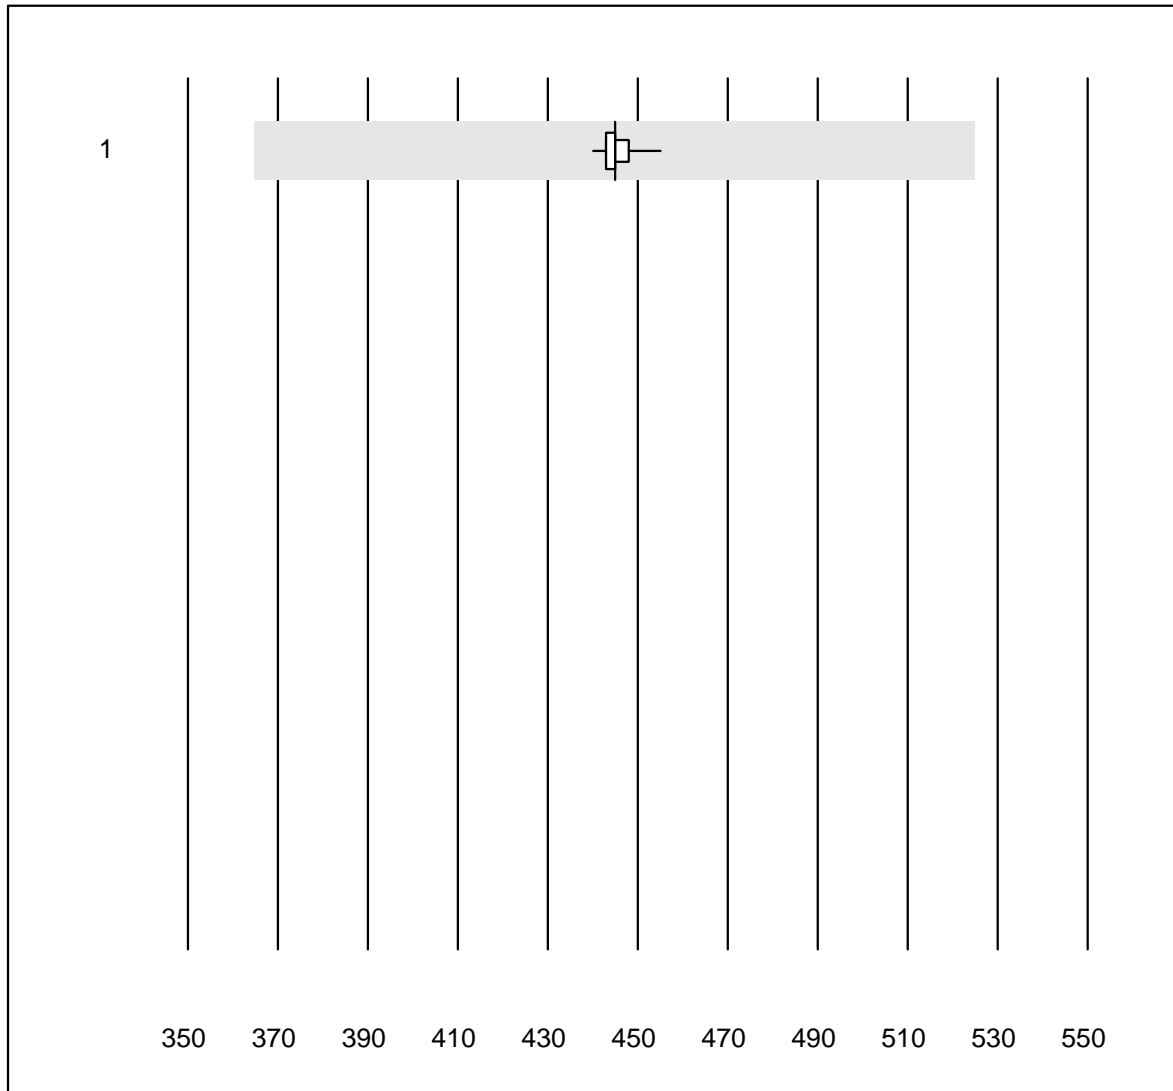


QUALAB Tolérance : 18 %

Bilirubin OR (µmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 ABL90 FLEX / PLUS	25	100.0	0.0	0.0	444.9	0.7	e

Troponine I

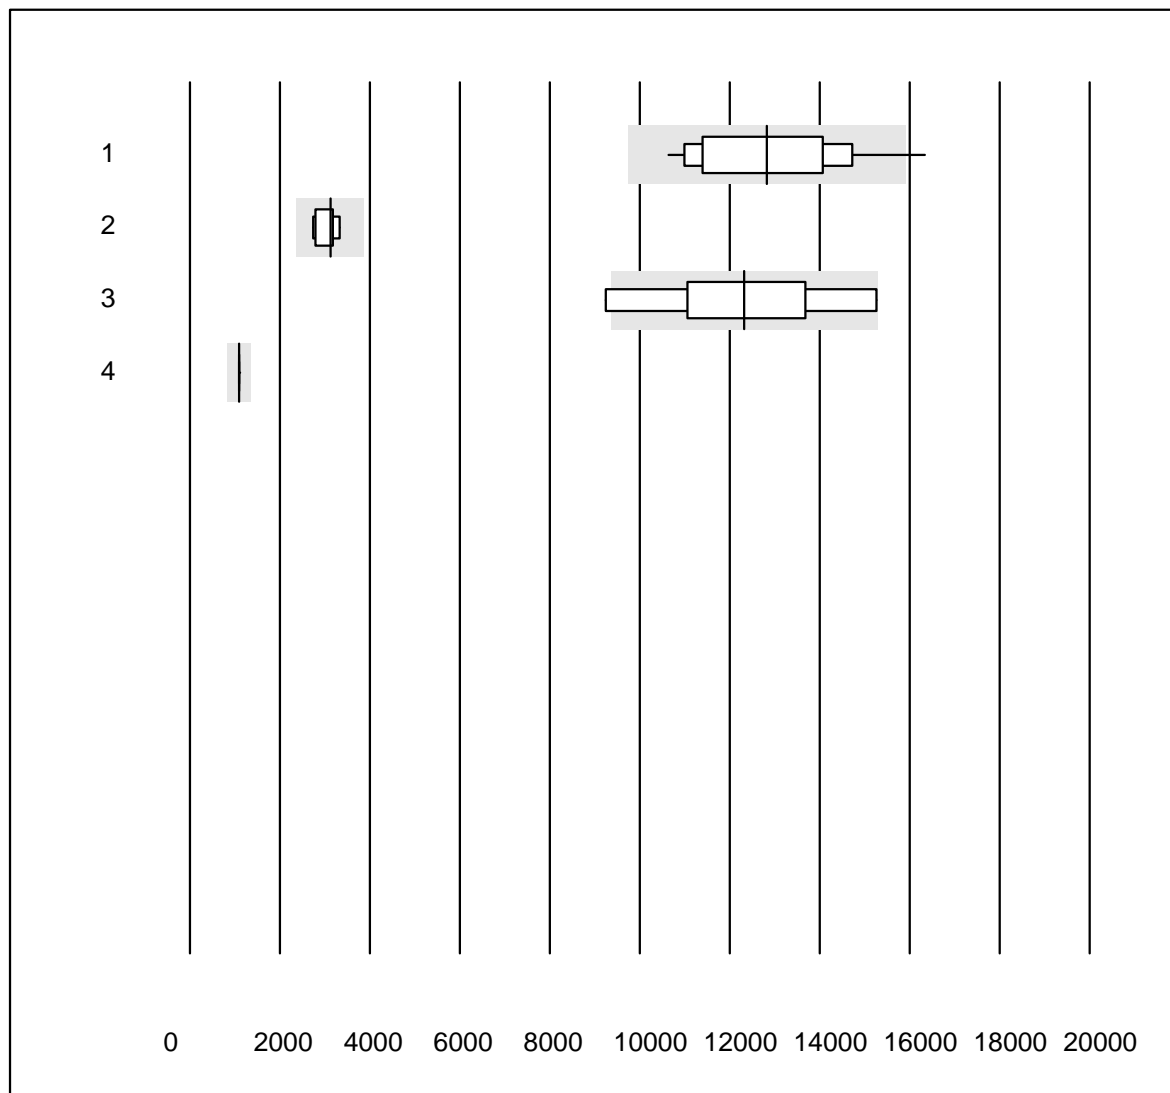


QUALAB Tolérance : 24 %

Troponine I (ng/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Vidas	11	90.9	9.1	0.0	12831.1	13.5	e*
2 Architect High Sensi	9	100.0	0.0	0.0	3121.4	7.8	e
3 Autres méthodes	7	85.7	14.3	0.0	12324.0	15.7	e*
4 AQT 90 FLEX	5	100.0	0.0	0.0	1100.0	0.0	e

Troponine T

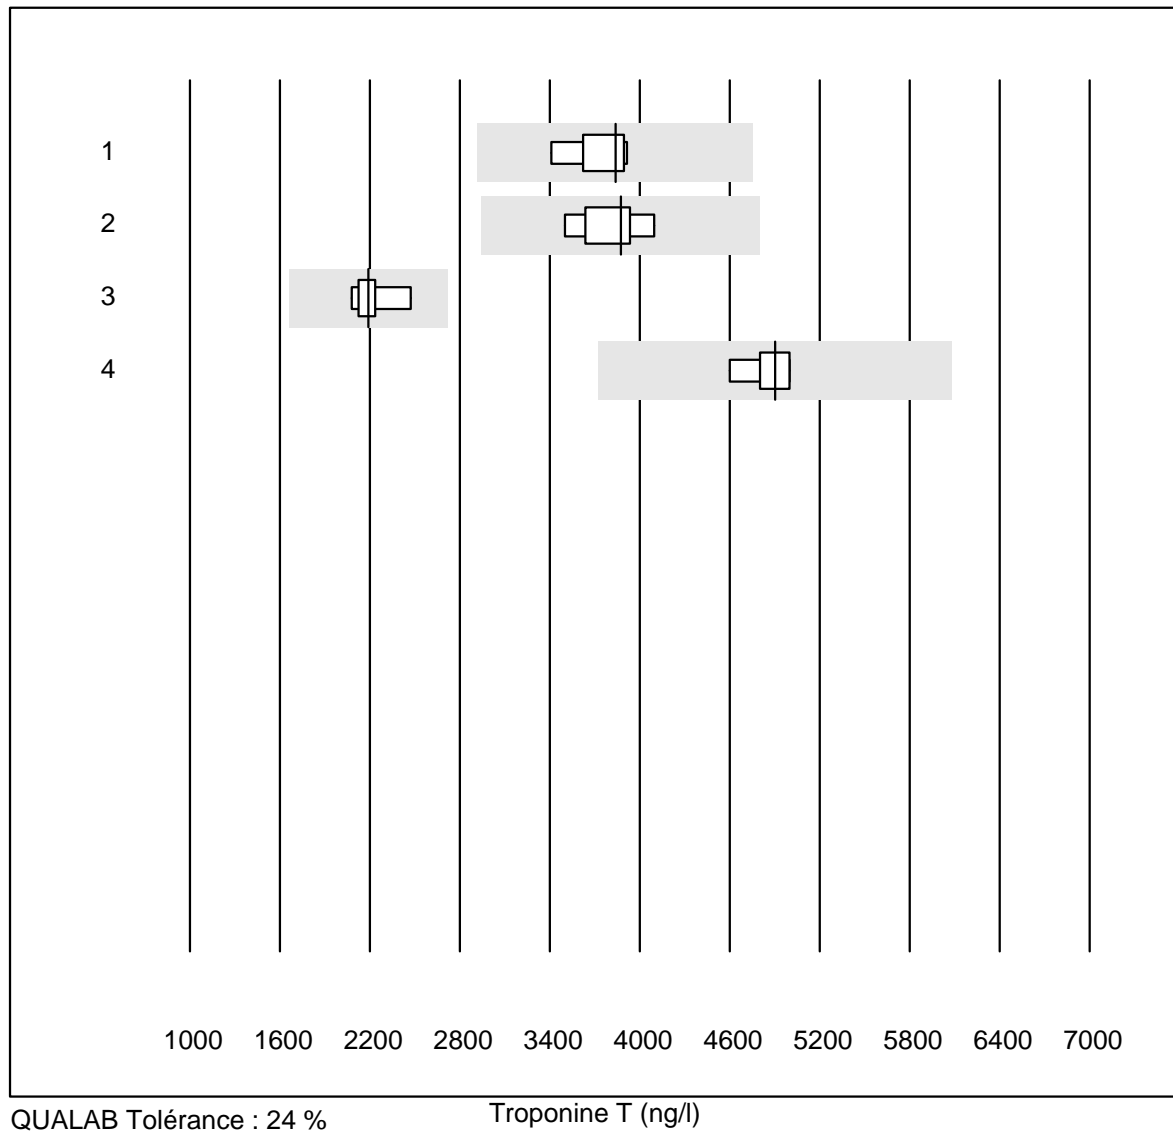


QUALAB Tolérance : 24 %

Troponine T (ng/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas hs	7	100.0	0.0	0.0	3837.00	4.9	e
2 Cobas hs STAT	8	100.0	0.0	0.0	3873.00	5.0	e
3 Cobas E / Elecsys	5	100.0	0.0	0.0	2192.00	6.9	e*
4 AQT 90 FLEX	5	100.0	0.0	0.0	4900.00	3.4	e

Myoglobine

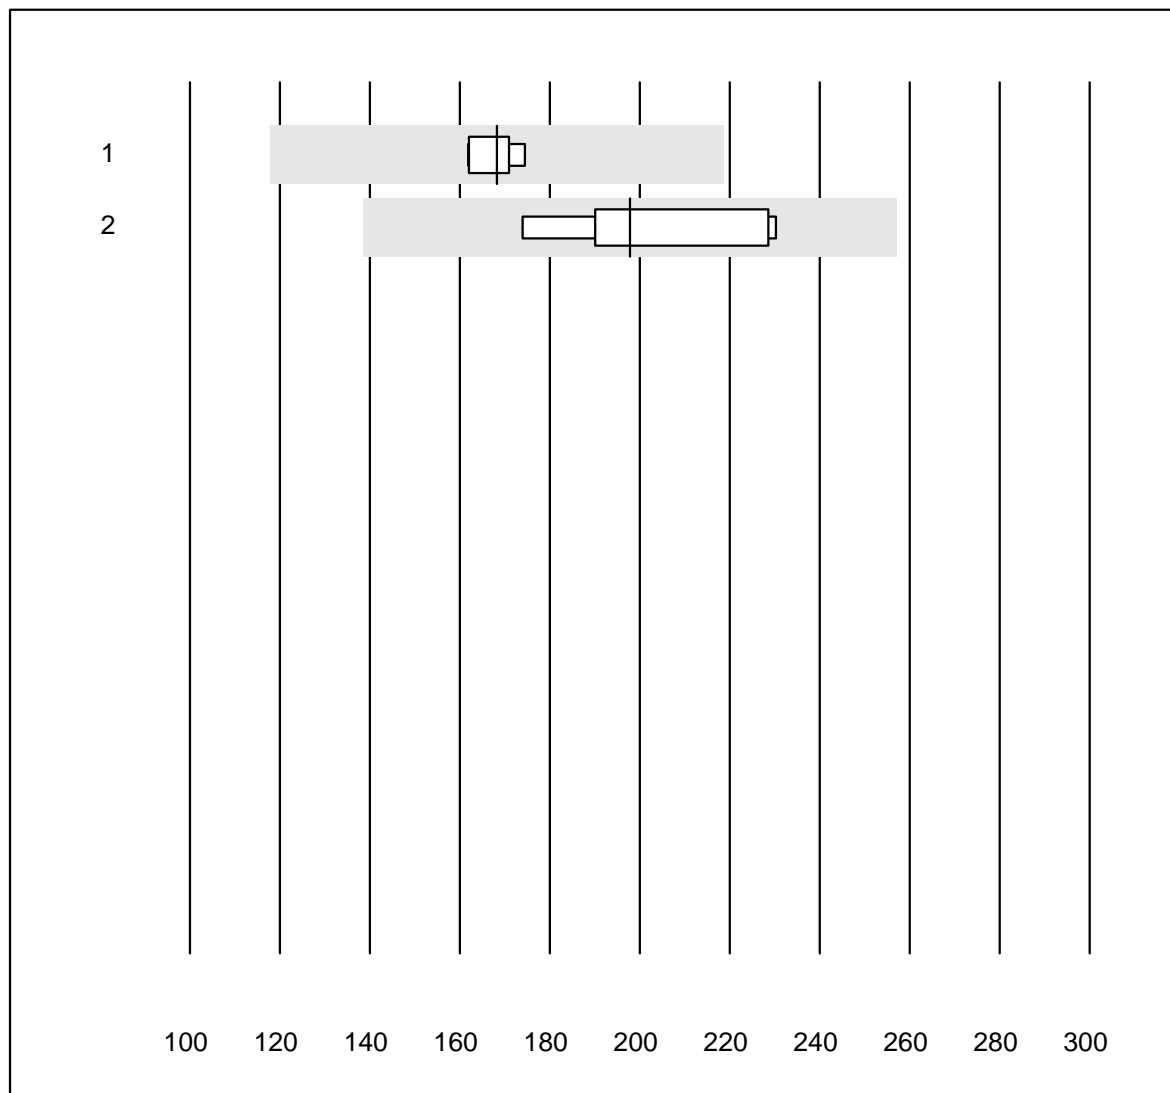


QUALAB Tolérance : 30 %

Myoglobine (µg/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	6	100.0	0.0	0.0	168.3	3.0	e
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	197.8	12.1	e*

masse CK-MB

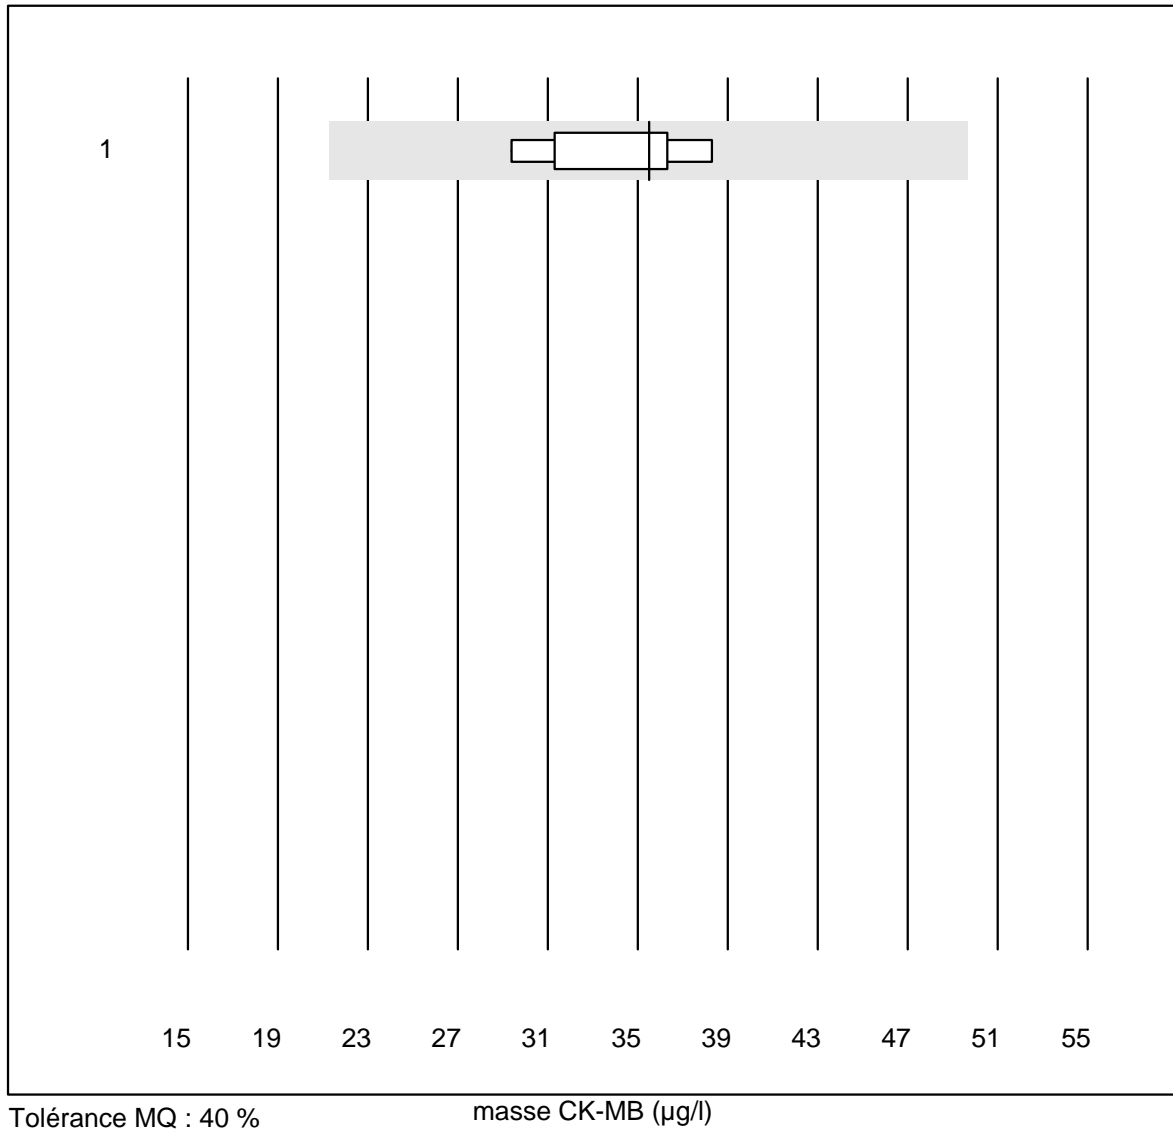


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	5	100.0	0.0	0.0	35.5	10.8	e*

NT-proBNP

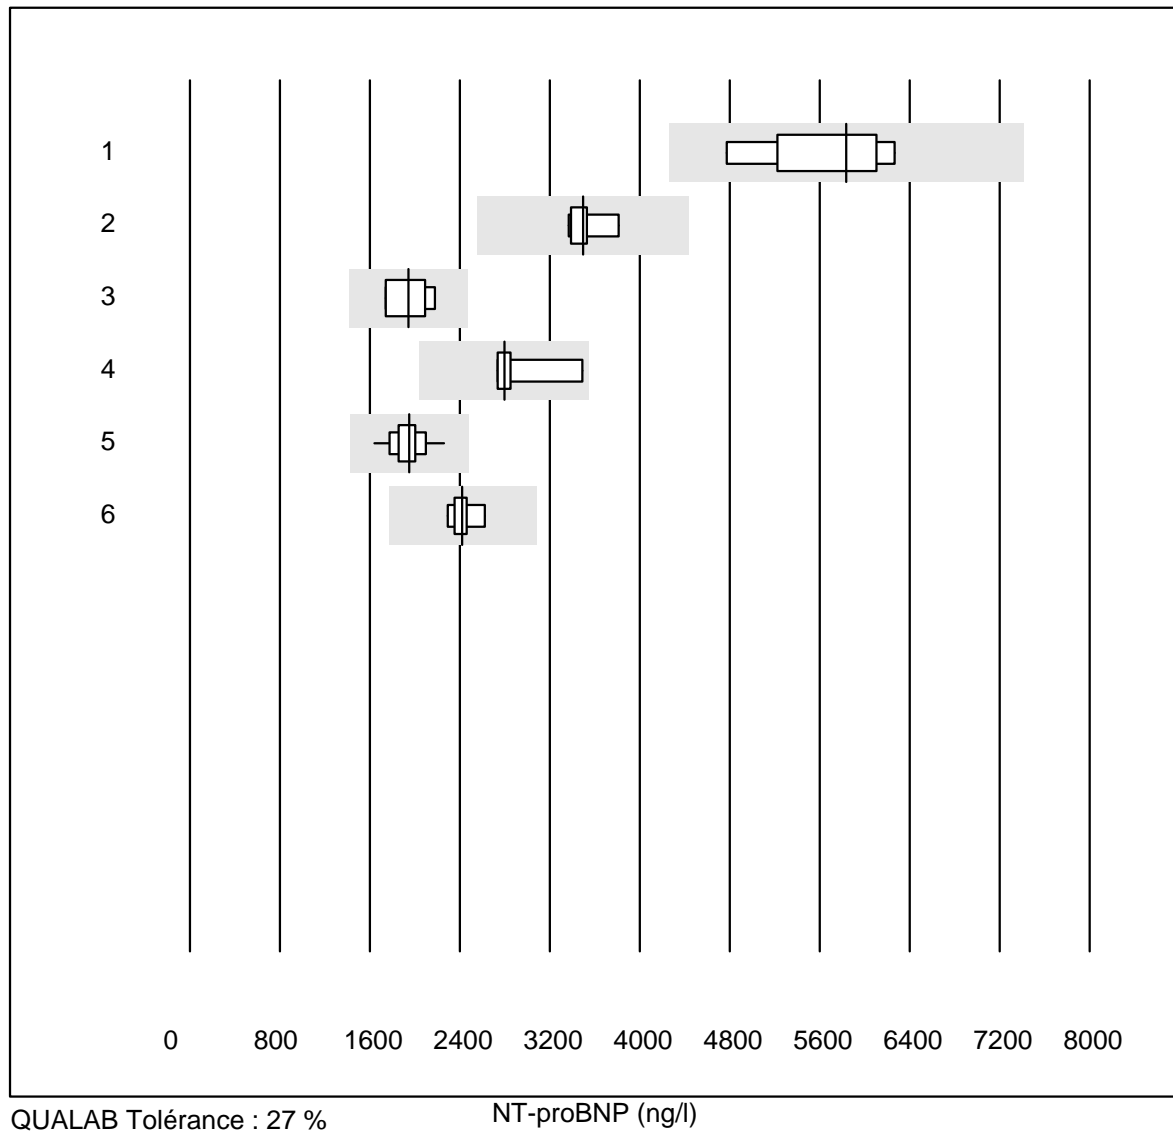

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Pathfast	6	100.0	0.0	0.0	5836.5	10.0	e*
2 AQT 90 FLEX	8	100.0	0.0	0.0	3495.0	3.9	e
3 VIDAS	8	100.0	0.0	0.0	1945.5	9.5	e*
4 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	2796.0	12.2	e*
5 Cobas E / Elecsys	16	100.0	0.0	0.0	1950.7	7.5	e
6 Architect	7	100.0	0.0	0.0	2422.0	4.2	e

TSH

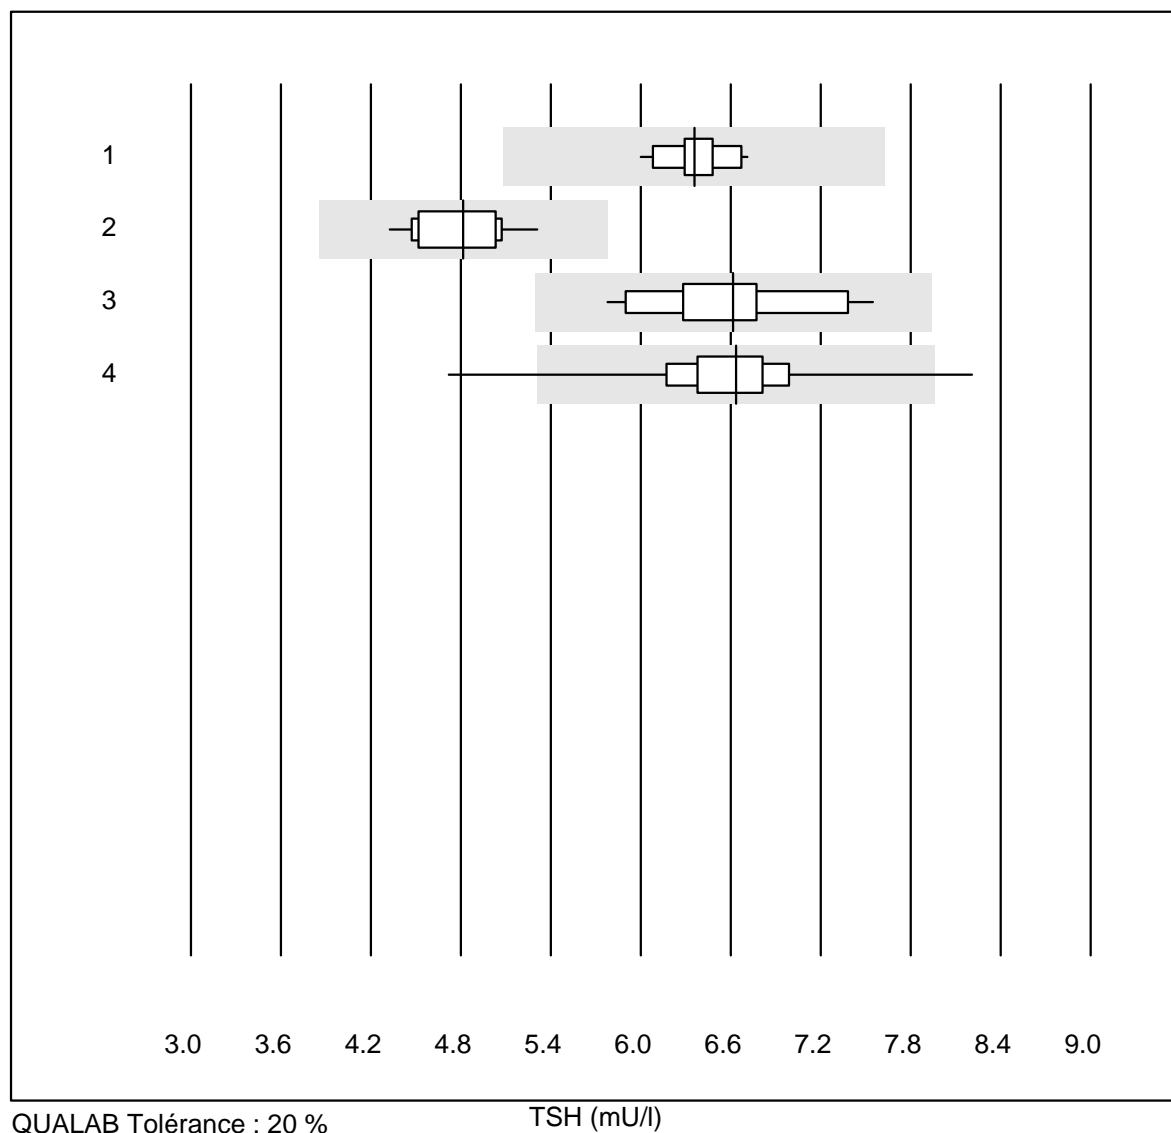


QUALAB Tolérance : 20 %

TSH (mU/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	17	100.0	0.0	0.0	6.36	3.0	e
2 Architect	11	100.0	0.0	0.0	4.82	6.3	e
3 VIDAS	16	100.0	0.0	0.0	6.62	7.2	e
4 AFIAS	37	89.2	8.1	2.7	6.63	8.6	e

T3

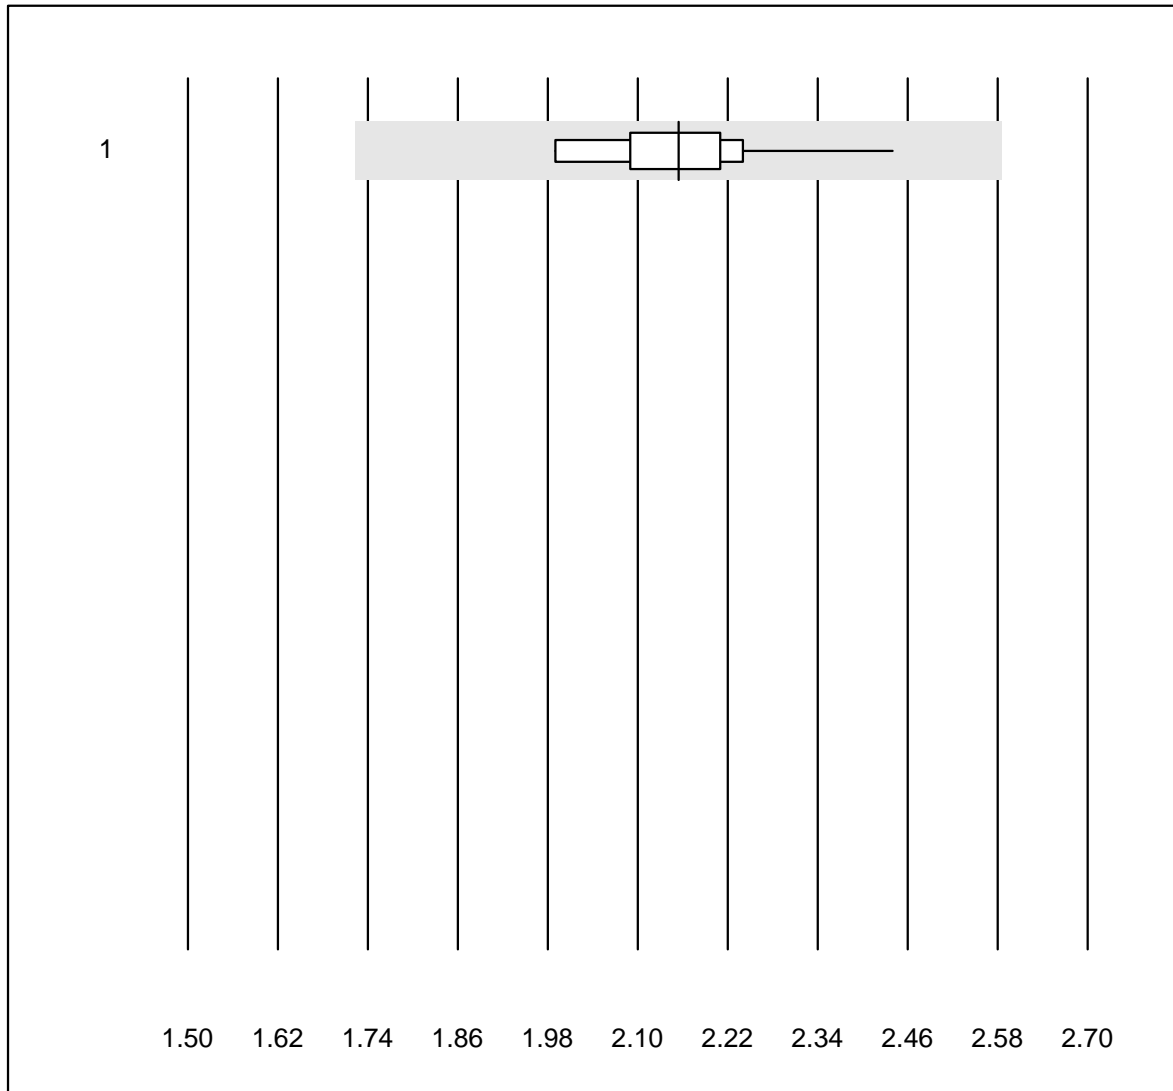


Tolérance MQ : 20 %

T3 (nmol/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 AFIAS	10	100.0	0.0	0.0	2.2	5.7	e

T4

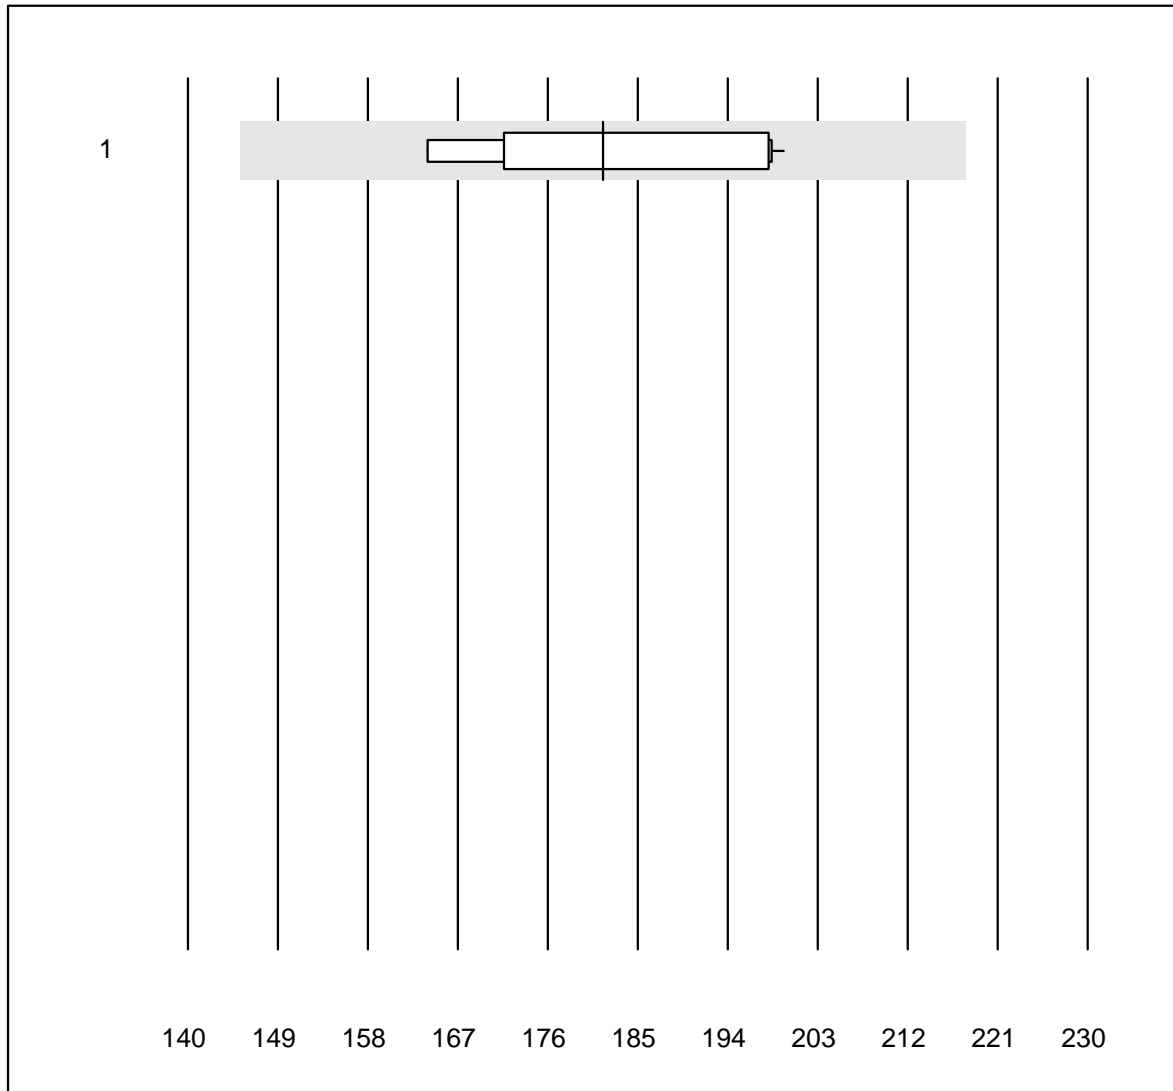


Tolérance MQ : 20 %


T4 (nmol/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 AFIAS	10	100.0	0.0	0.0	182	7.3	e

FT3

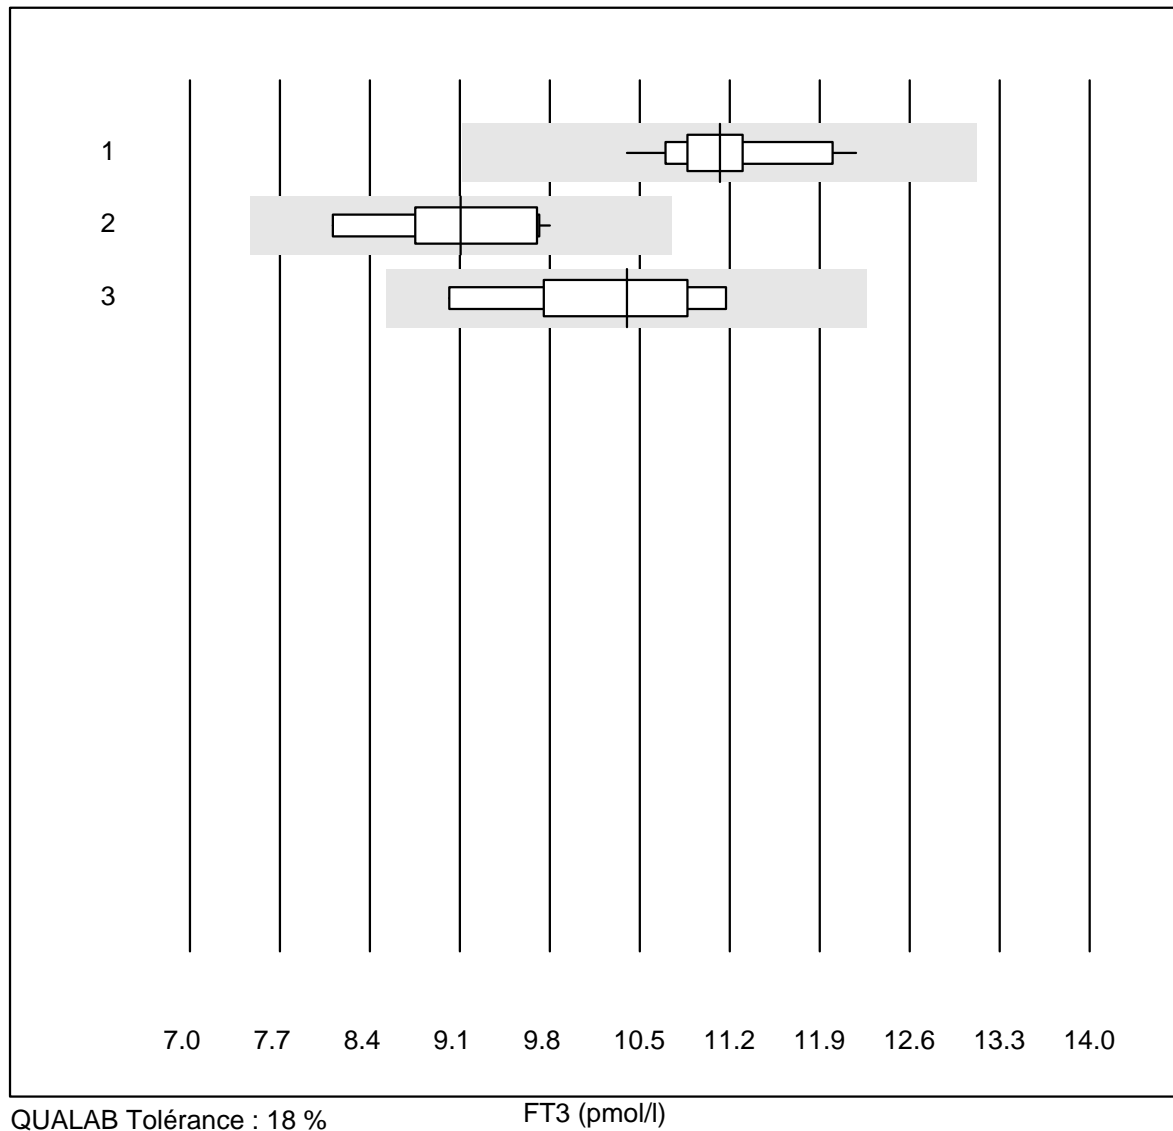

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	17	100.0	0.0	0.0	11.1	4.1	e
2 Architect	10	100.0	0.0	0.0	9.1	5.8	e
3 VIDAS	7	100.0	0.0	0.0	10.4	7.1	e*

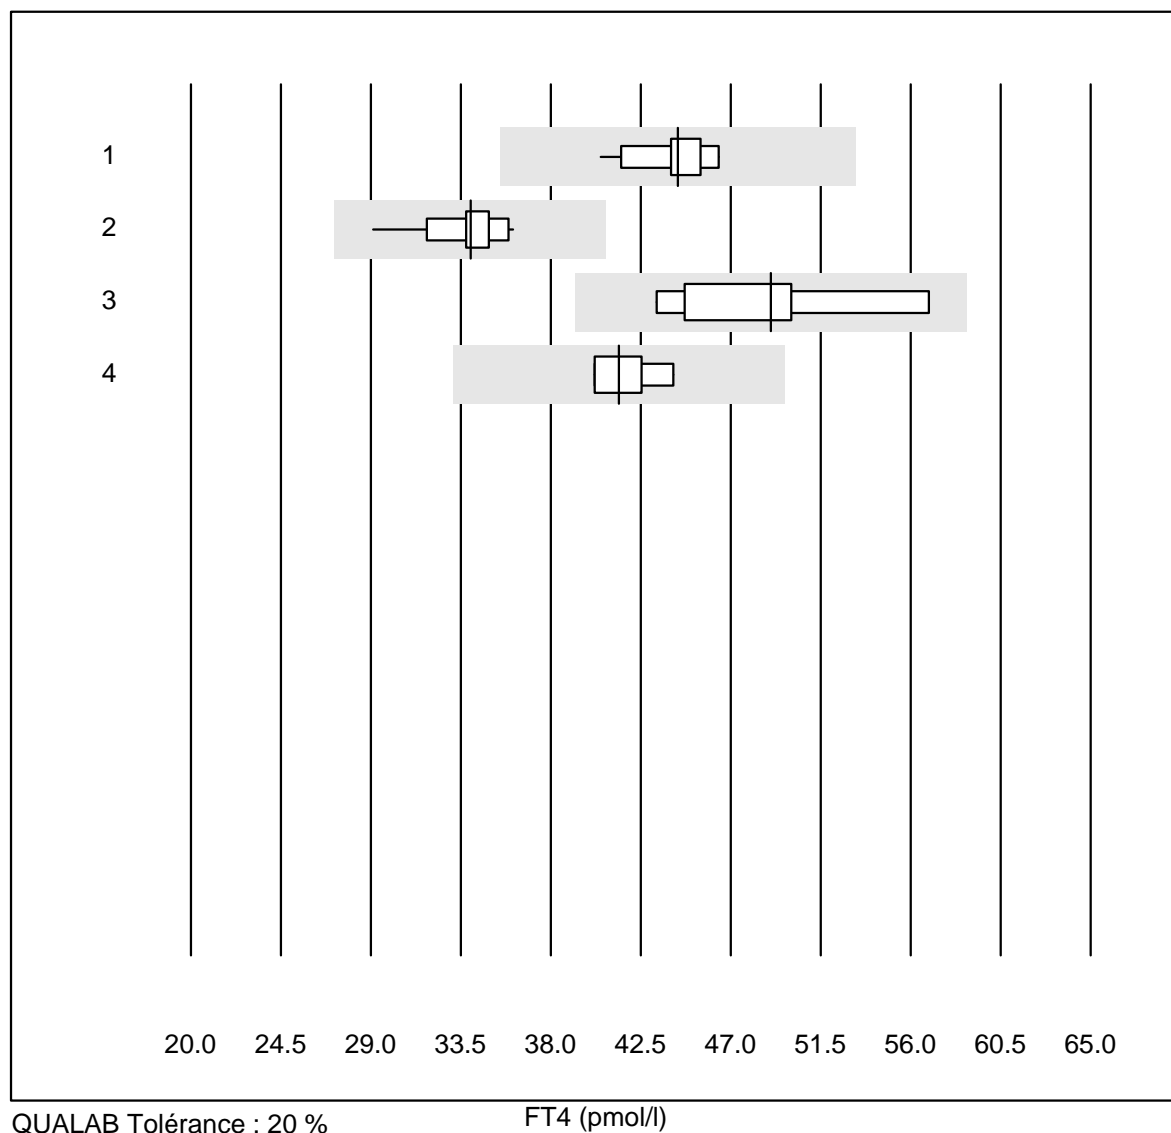
FT4

QUALAB Tolérance : 20 %

FT4 (pmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	17	100.0	0.0	0.0	44.4	3.7	e
2 Architect	11	100.0	0.0	0.0	34.0	5.8	e
3 VIDAS	9	100.0	0.0	0.0	49.0	8.9	a
4 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	41.4	4.5	e

Testostérone

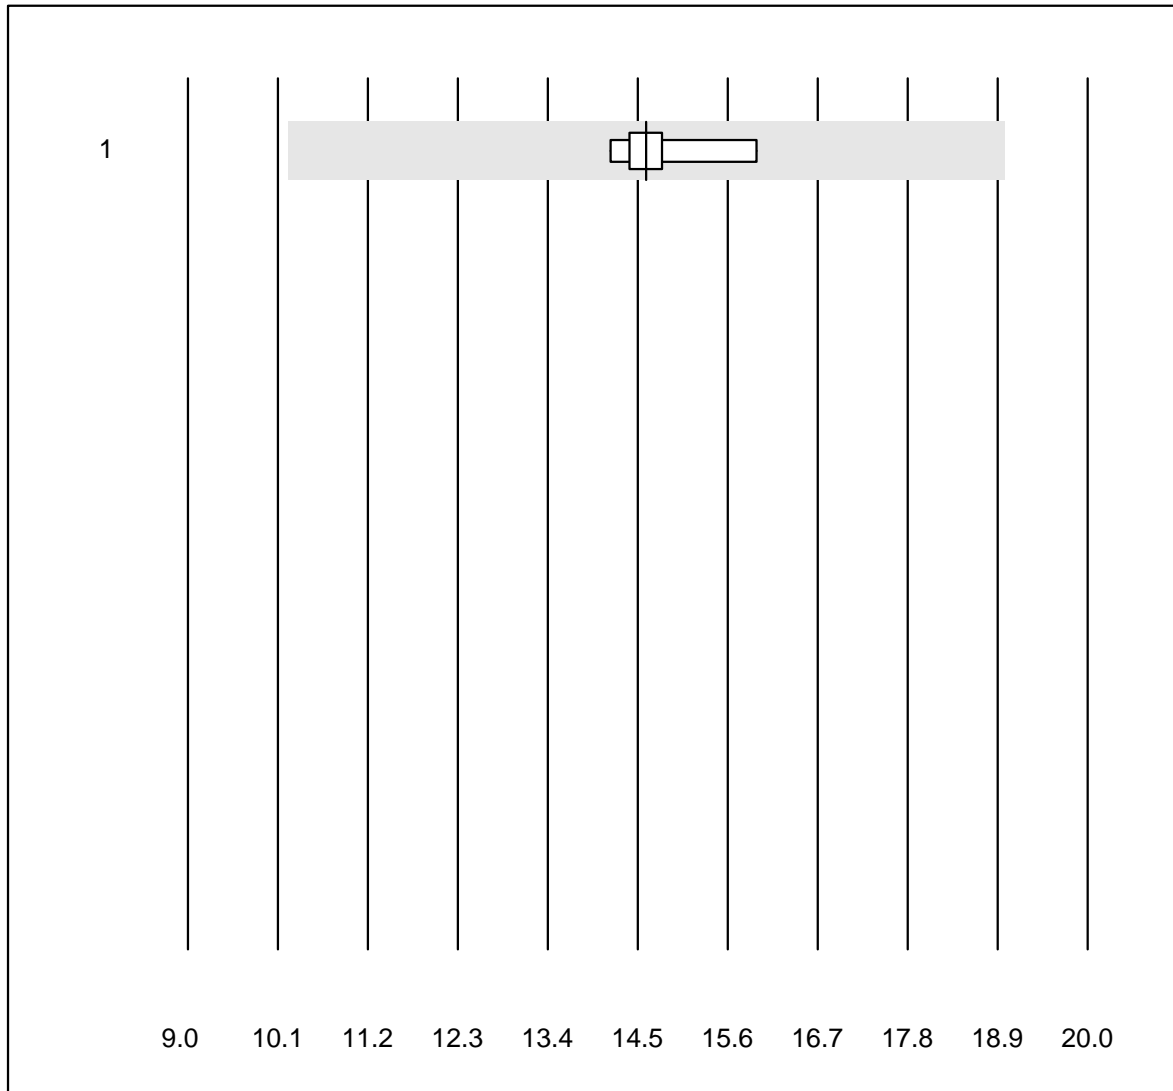


QUALAB Tolérance : 30 %

Testostérone (nmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	8	100.0	0.0	0.0	14.6	3.7	e

Estradiol

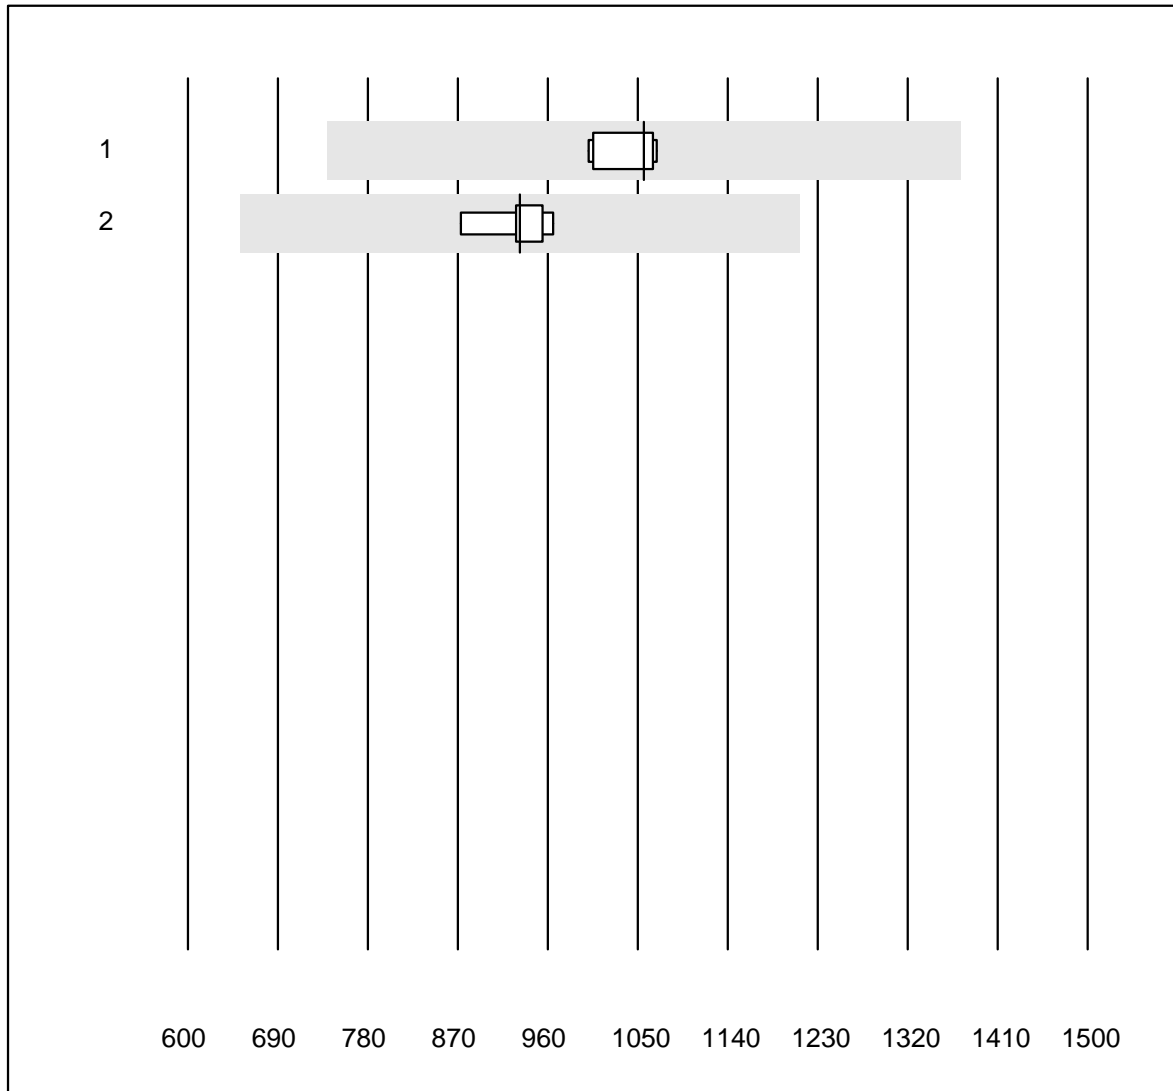


QUALAB Tolérance : 30 %

Estradiol (pmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	7	100.0	0.0	0.0	1056	2.8	e
2 Architect	6	100.0	0.0	0.0	932	3.5	e

SHBG

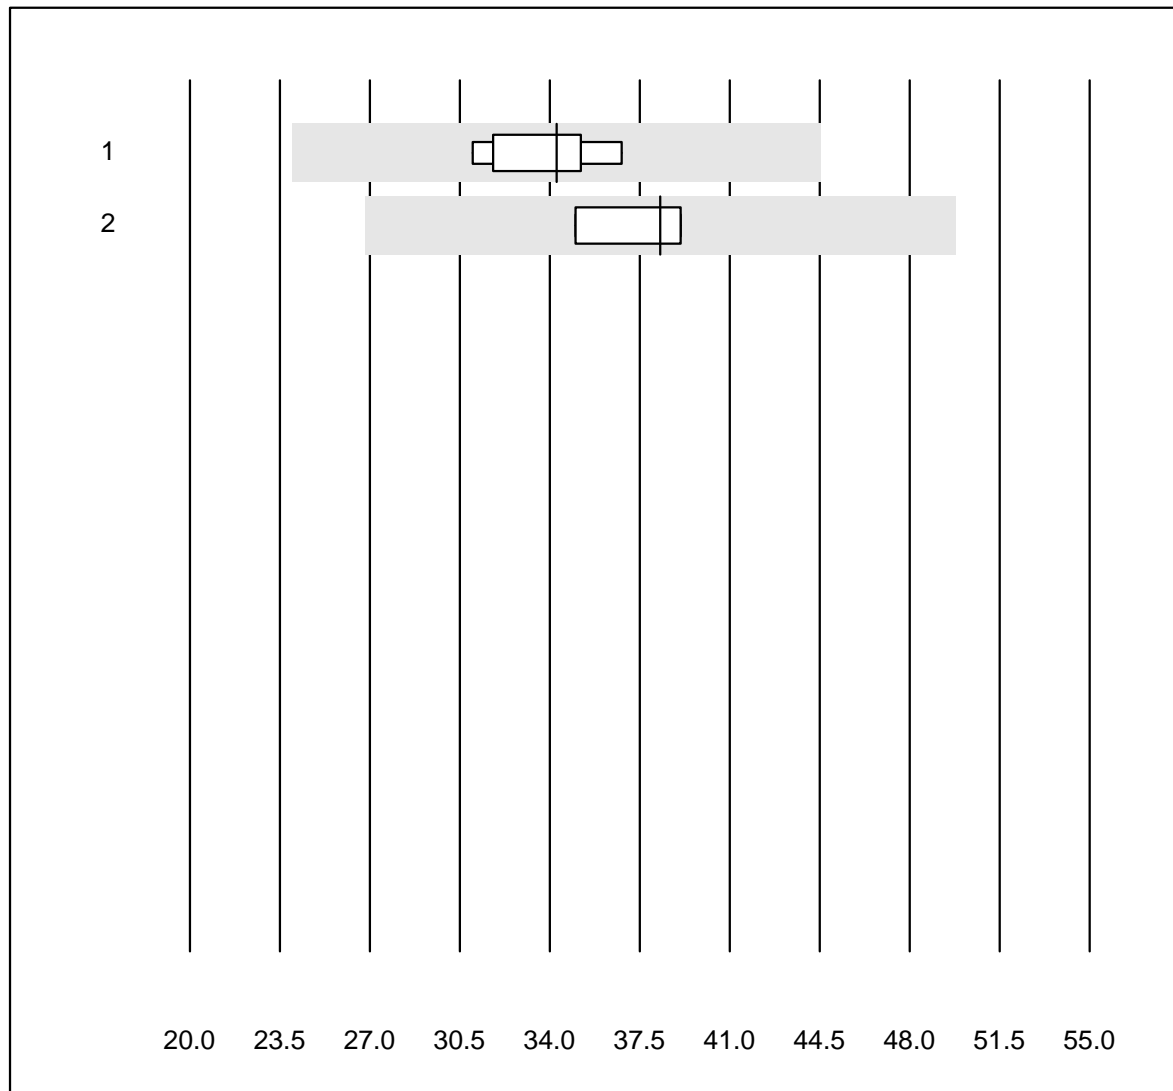


Tolérance MQ : 30 %

SHBG (nmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	6	100.0	0.0	0.0	34.3	6.4	e
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	38.3	5.1	e

Cortisol

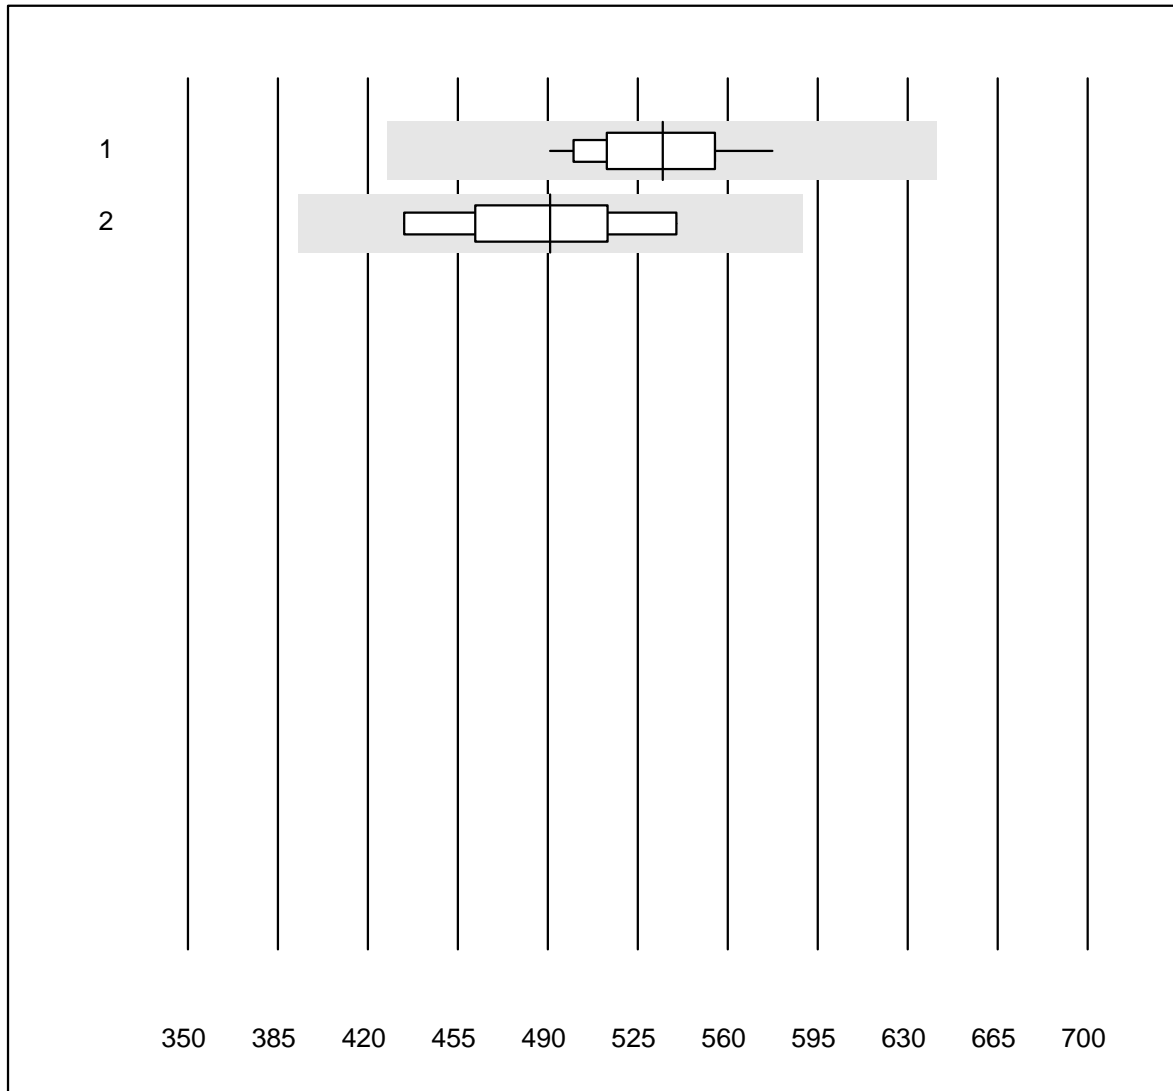


QUALAB Tolérance : 20 %

Cortisol (nmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	11	100.0	0.0	0.0	535	4.8	e
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	491	8.5	e*

Progesteron

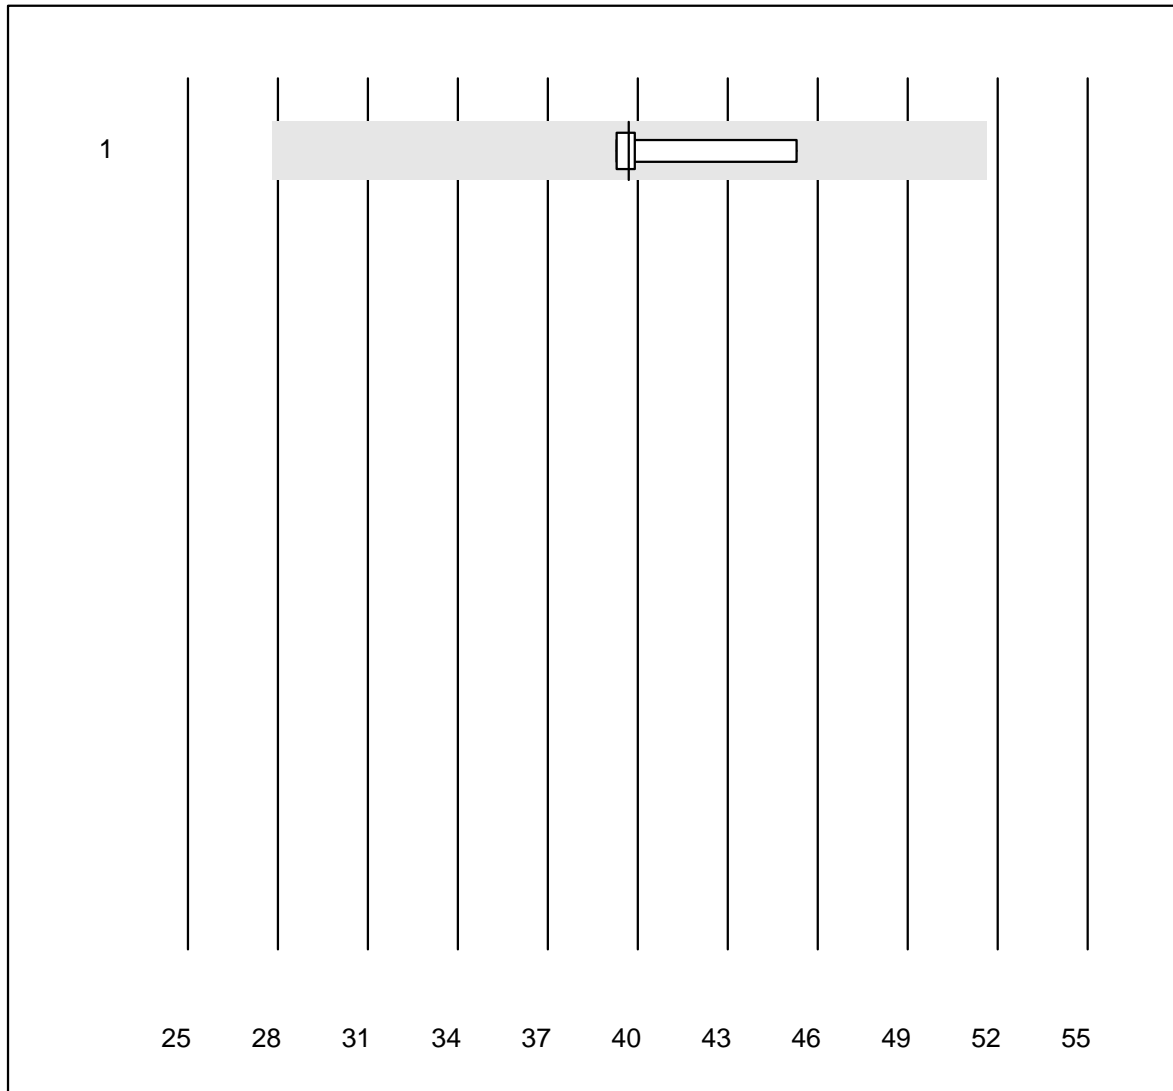


Tolérance MQ : 30 %

Progesteron (nmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	39.7	7.0	e

DHEAS

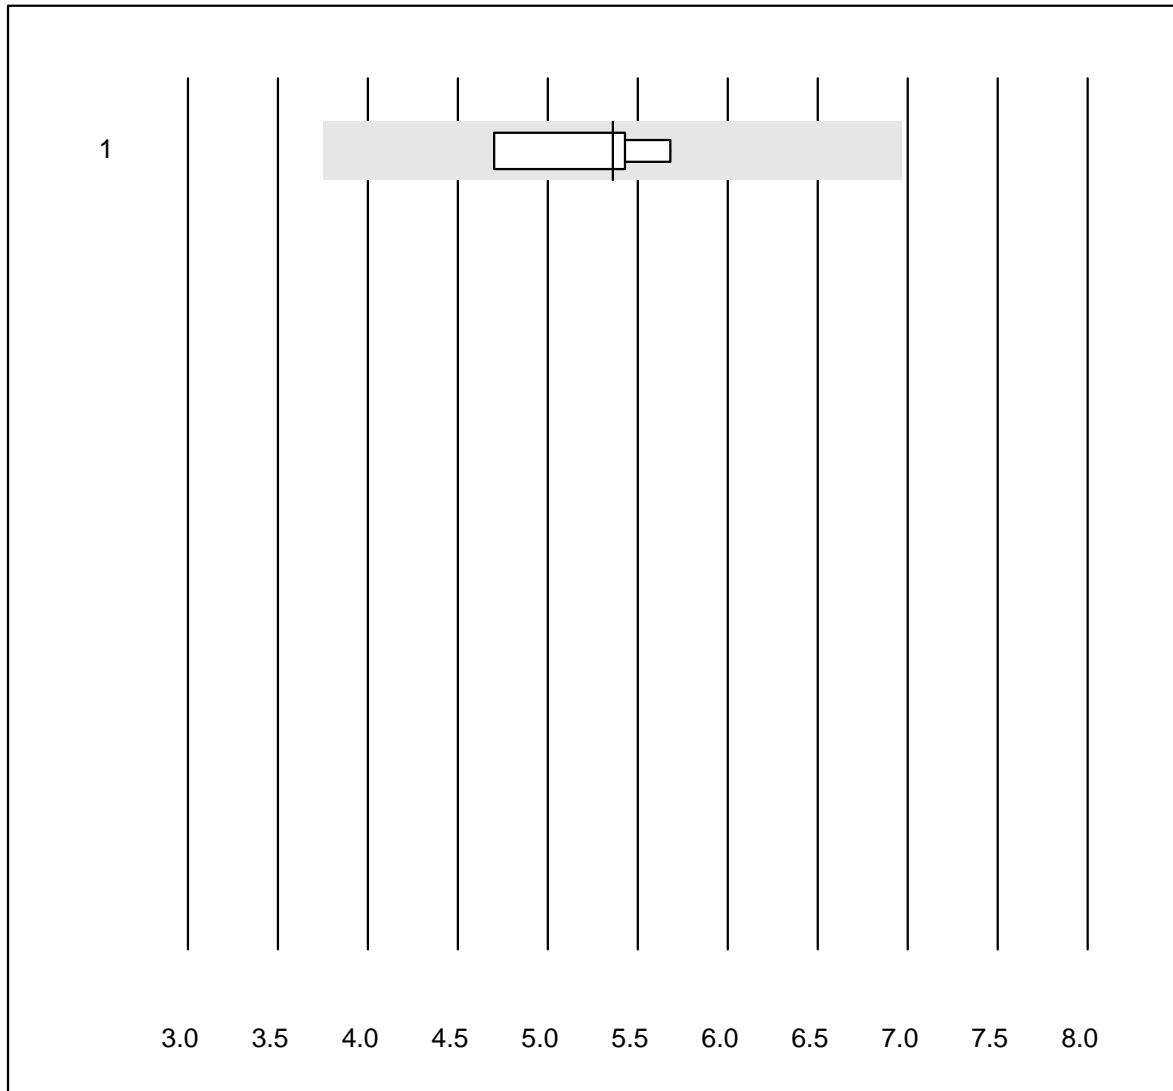


Tolérance MQ : 30 %

DHEAS (µmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	5.36	7.9	e*

Luteinisierendes Hormon

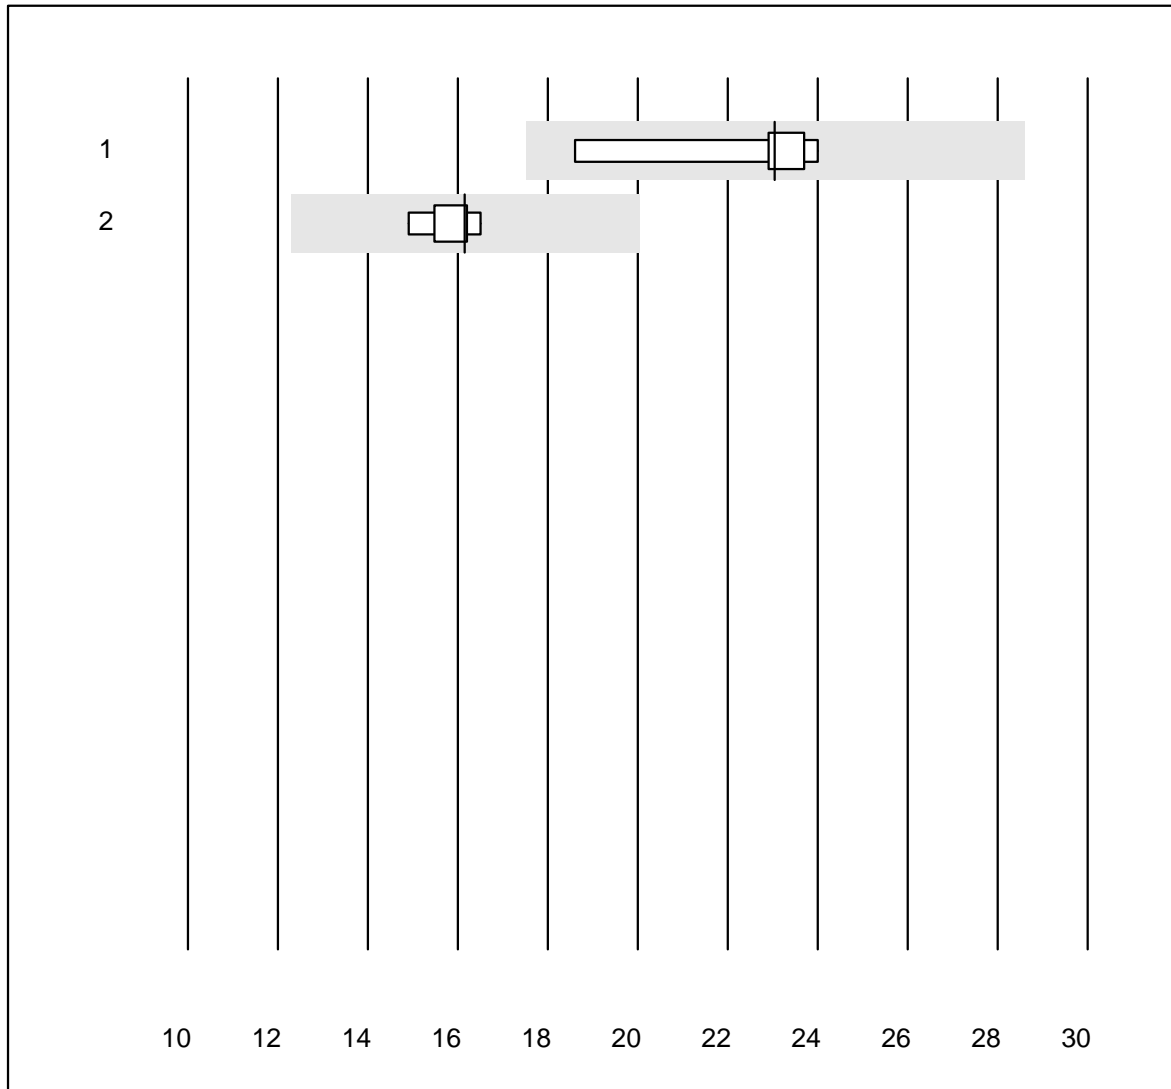


QUALAB Tolérance : 24 %

Luteinisierendes Hormon (U/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Roche, Cobas	8	100.0	0.0	0.0	23.1	7.7	e
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	16.2	4.1	e


Follikelstimulierendes Hormon

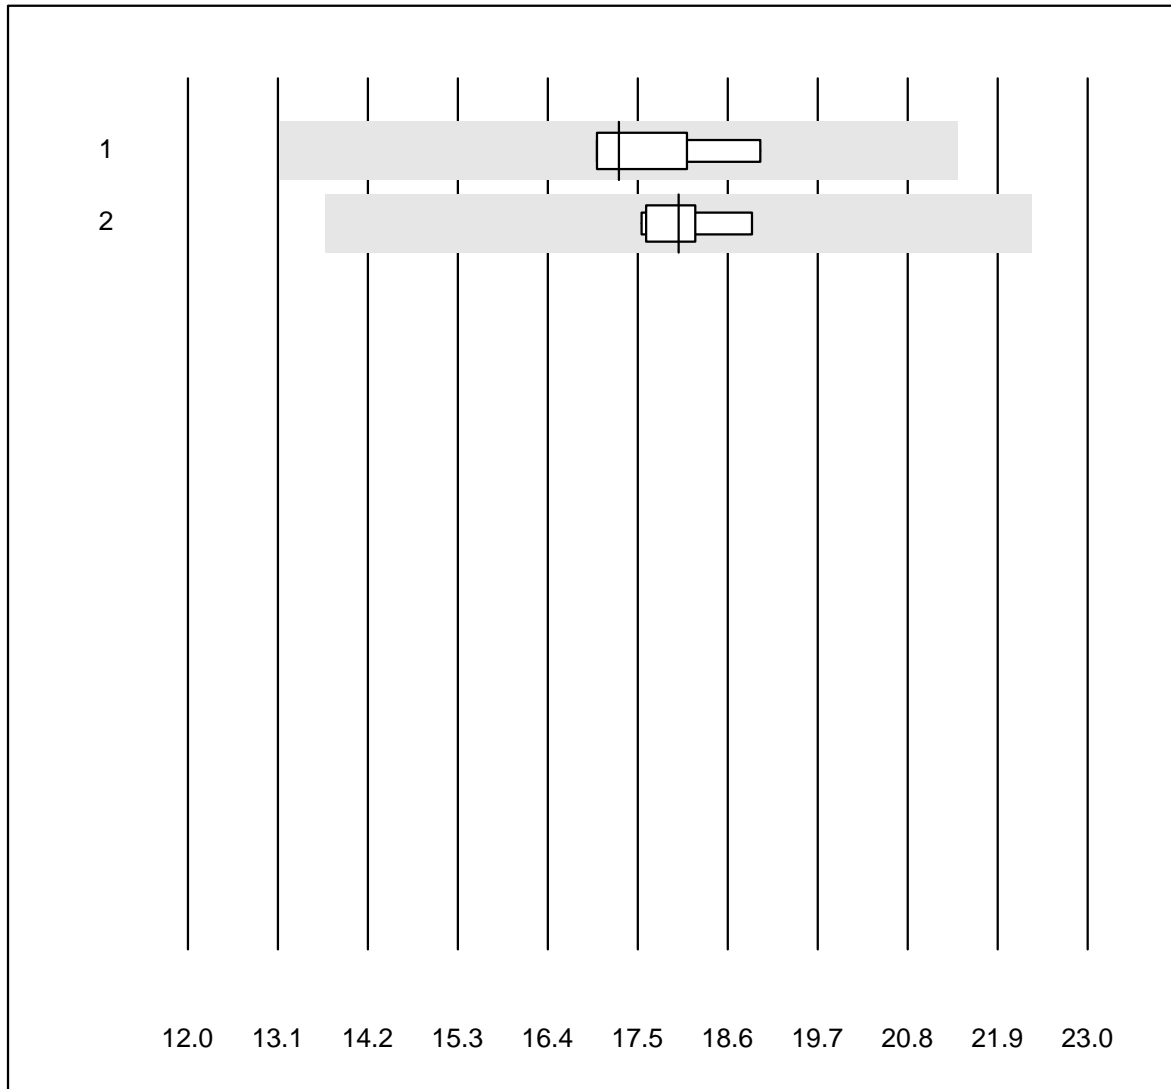

QUALAB Tolérance : 24 % Follikelstimulierendes Hormon (U/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Roche, Cobas	8	100.0	0.0	0.0	17.3	5.0	e
2 Architect	6	100.0	0.0	0.0	18.0	2.7	e

Prolaktin (PRL)

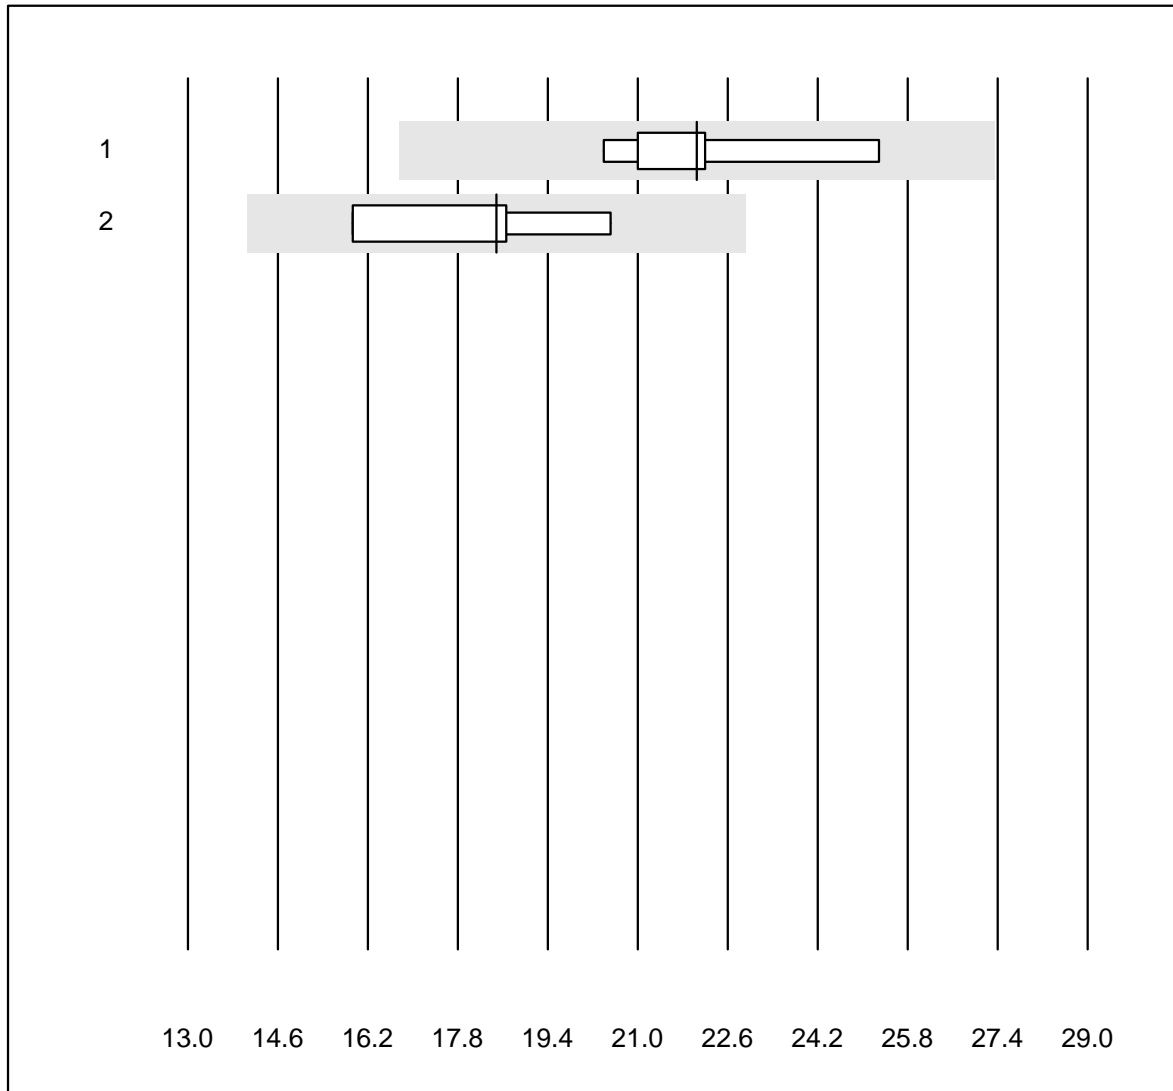


QUALAB Tolérance : 24 %

Prolaktin (PRL) (µg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas/Roche	8	100.0	0.0	0.0	22.1	7.0	e
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	18.5	10.2	e*

Insulin

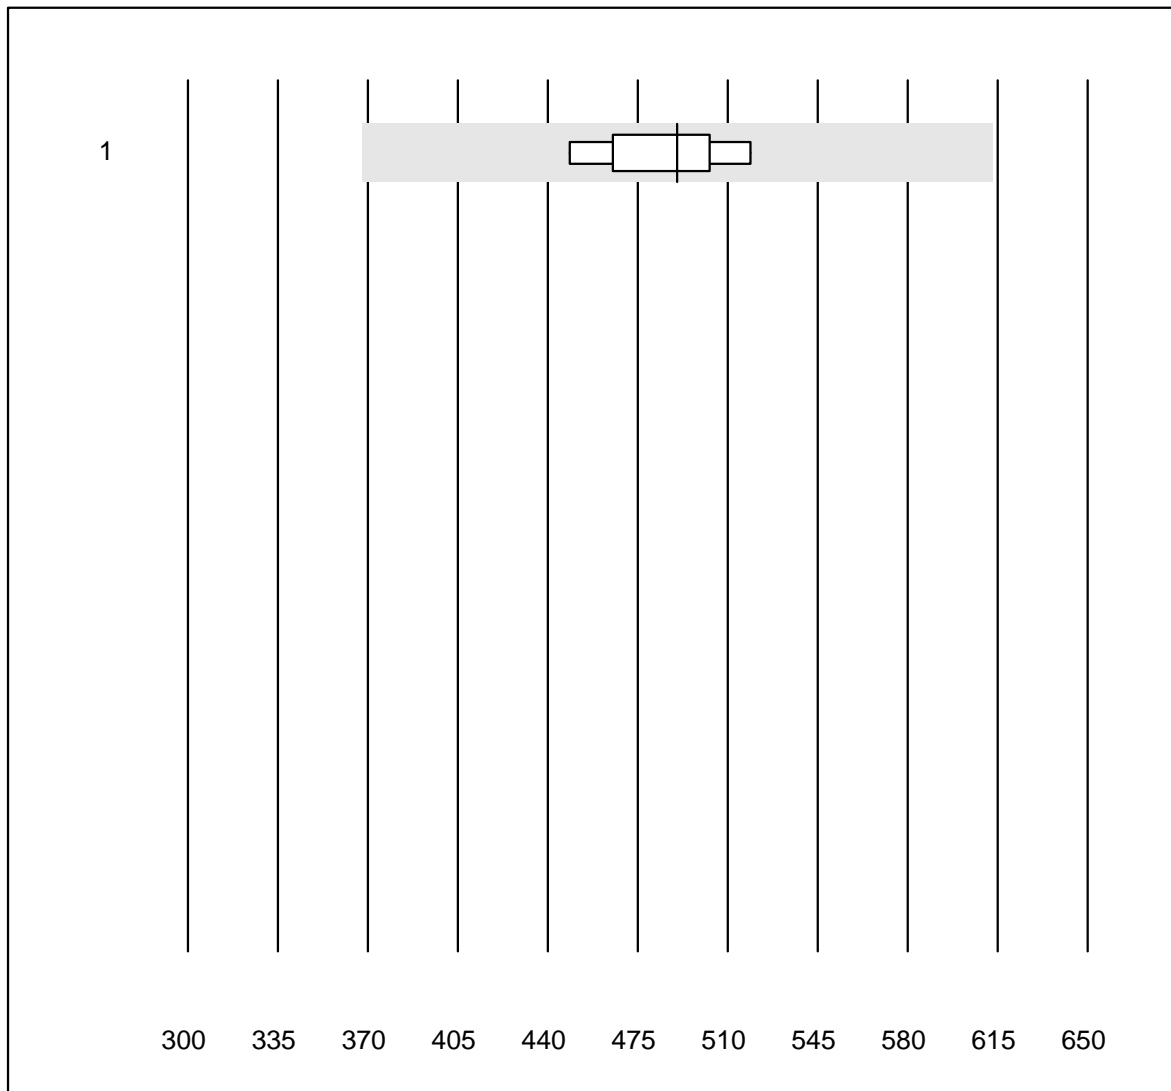


Tolérance MQ : 25 %

Insulin (pmol/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	7	100.0	0.0	0.0	490	4.8	e

HGH

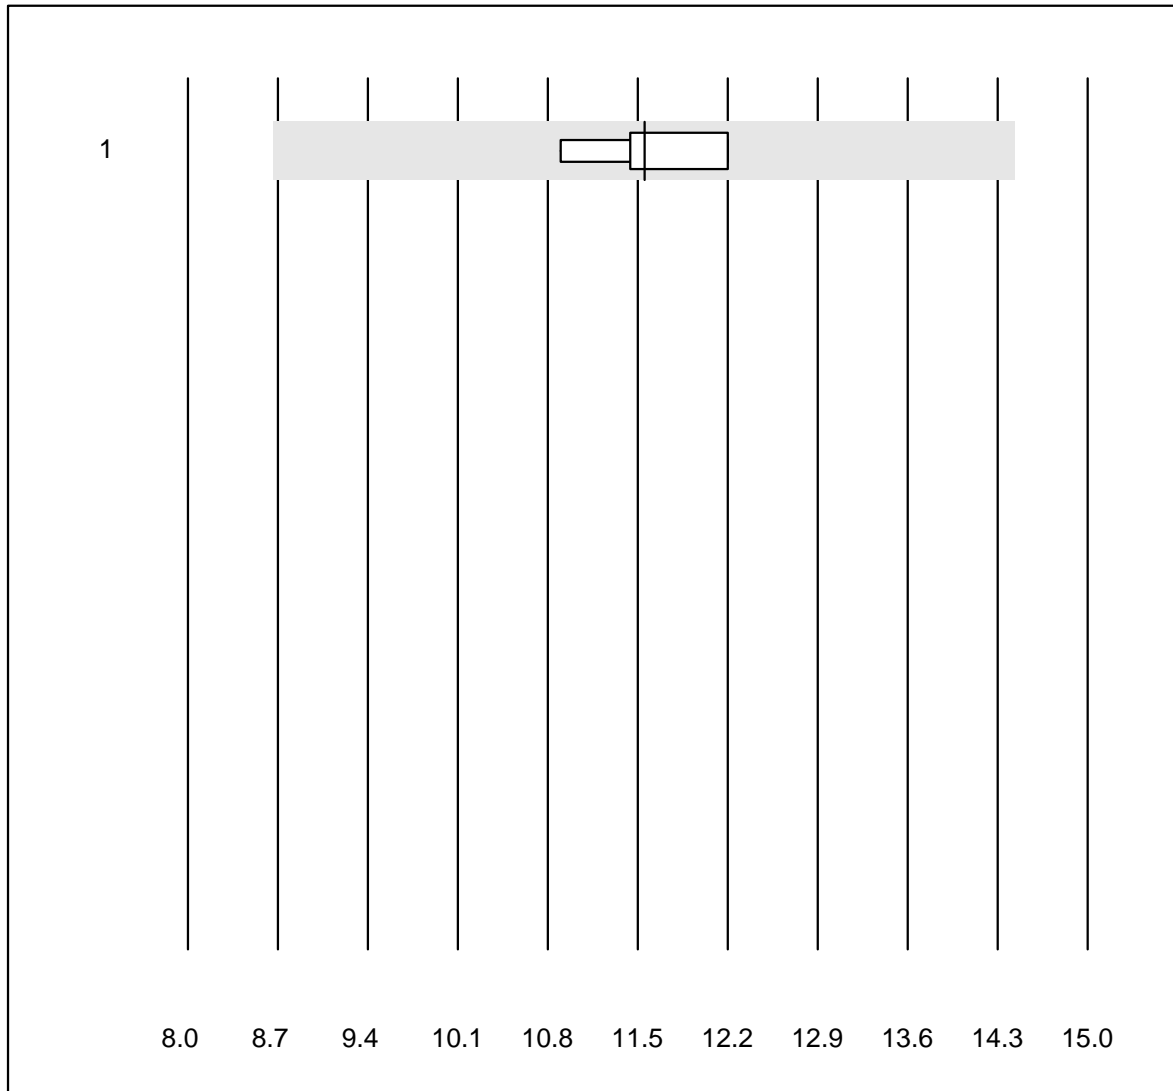


Tolérance MQ : 25 %

HGH (µg/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	11.55	4.3	e

Freies Testosteron

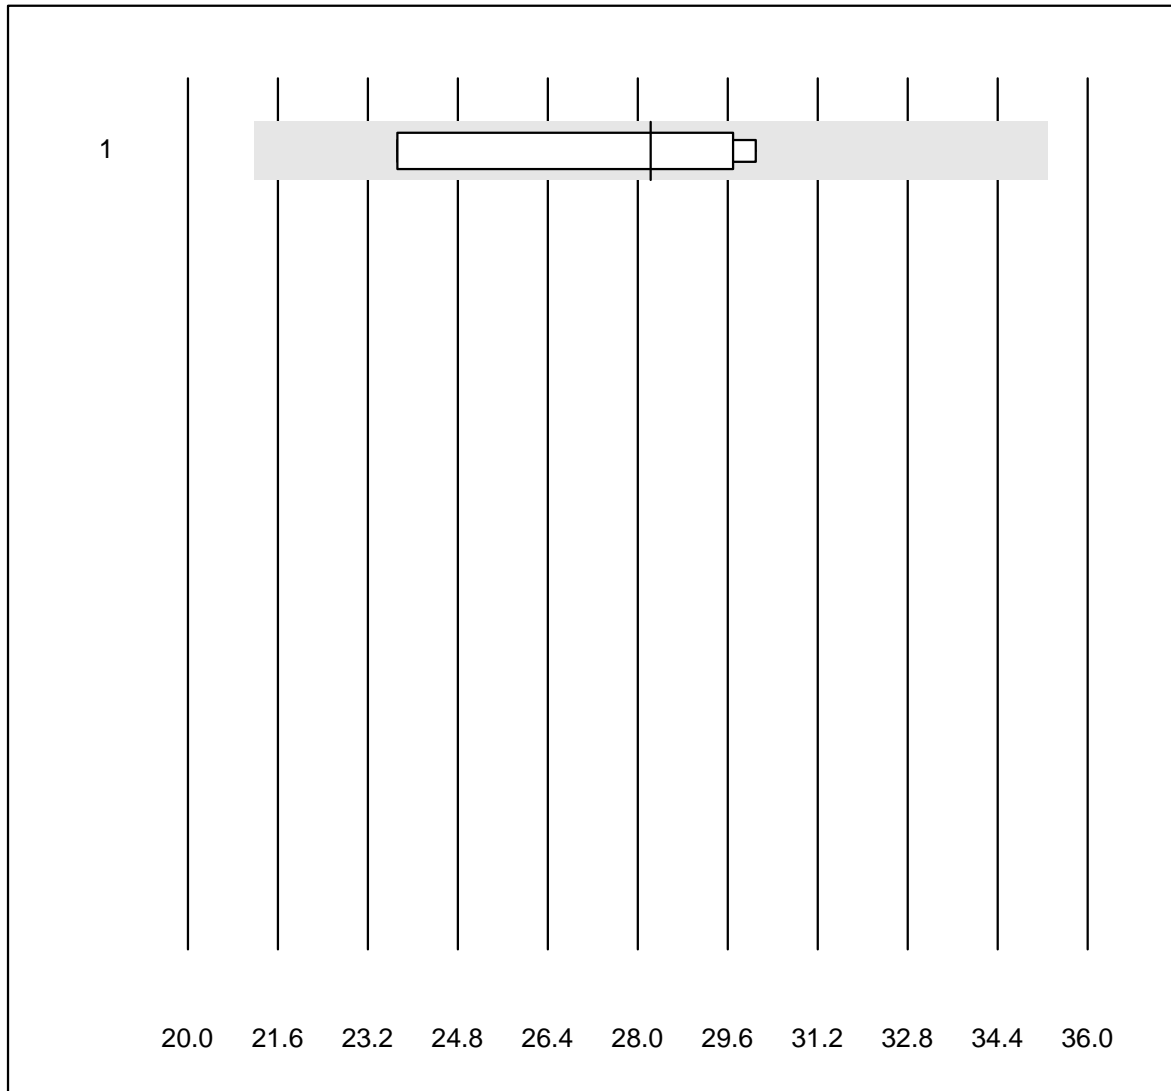


Tolérance MQ : 25 %

Freies Testosteron (pmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	28.2	10.8	e*

IGF-1

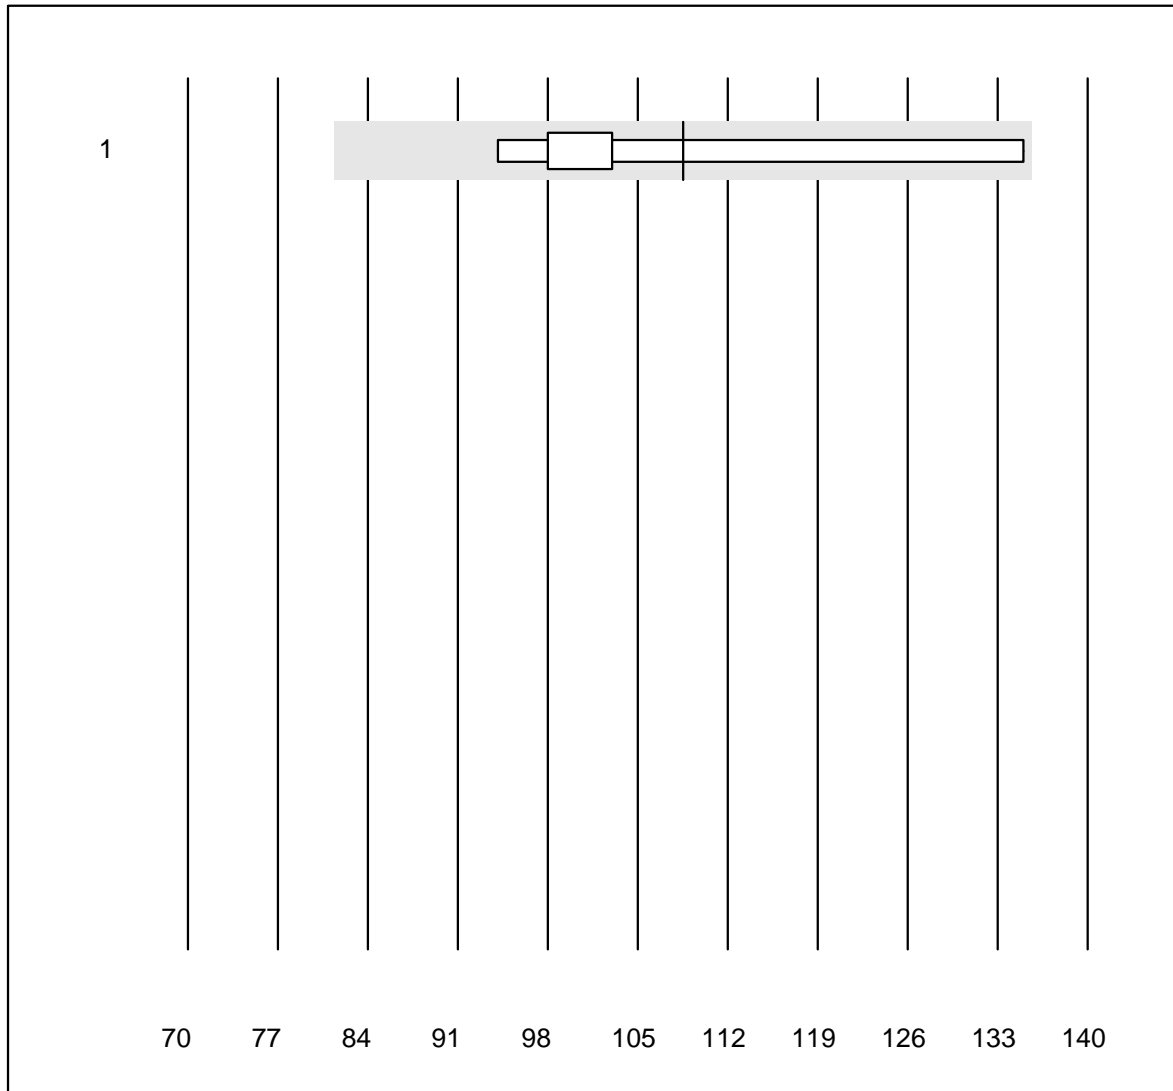


Tolérance MQ : 25 %

IGF-1 (µg/l)


No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Liaison	5	100.0	0.0	0.0	109	15.5	a

Troponine T CR

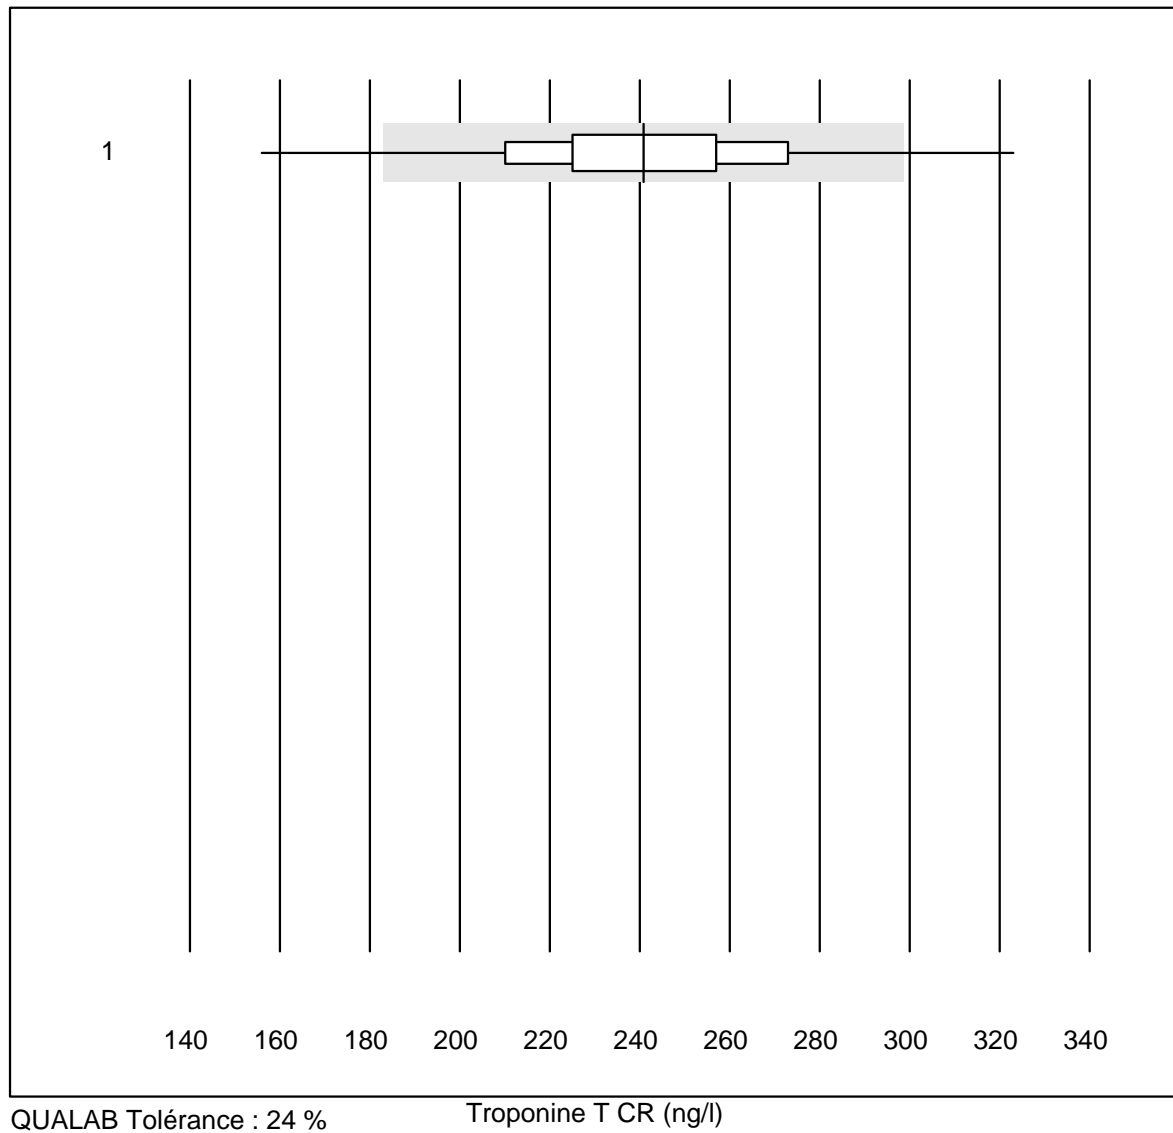


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas h 232	1278	96.2	2.7	1.1	240.88	10.4	e

D-Dimères CR

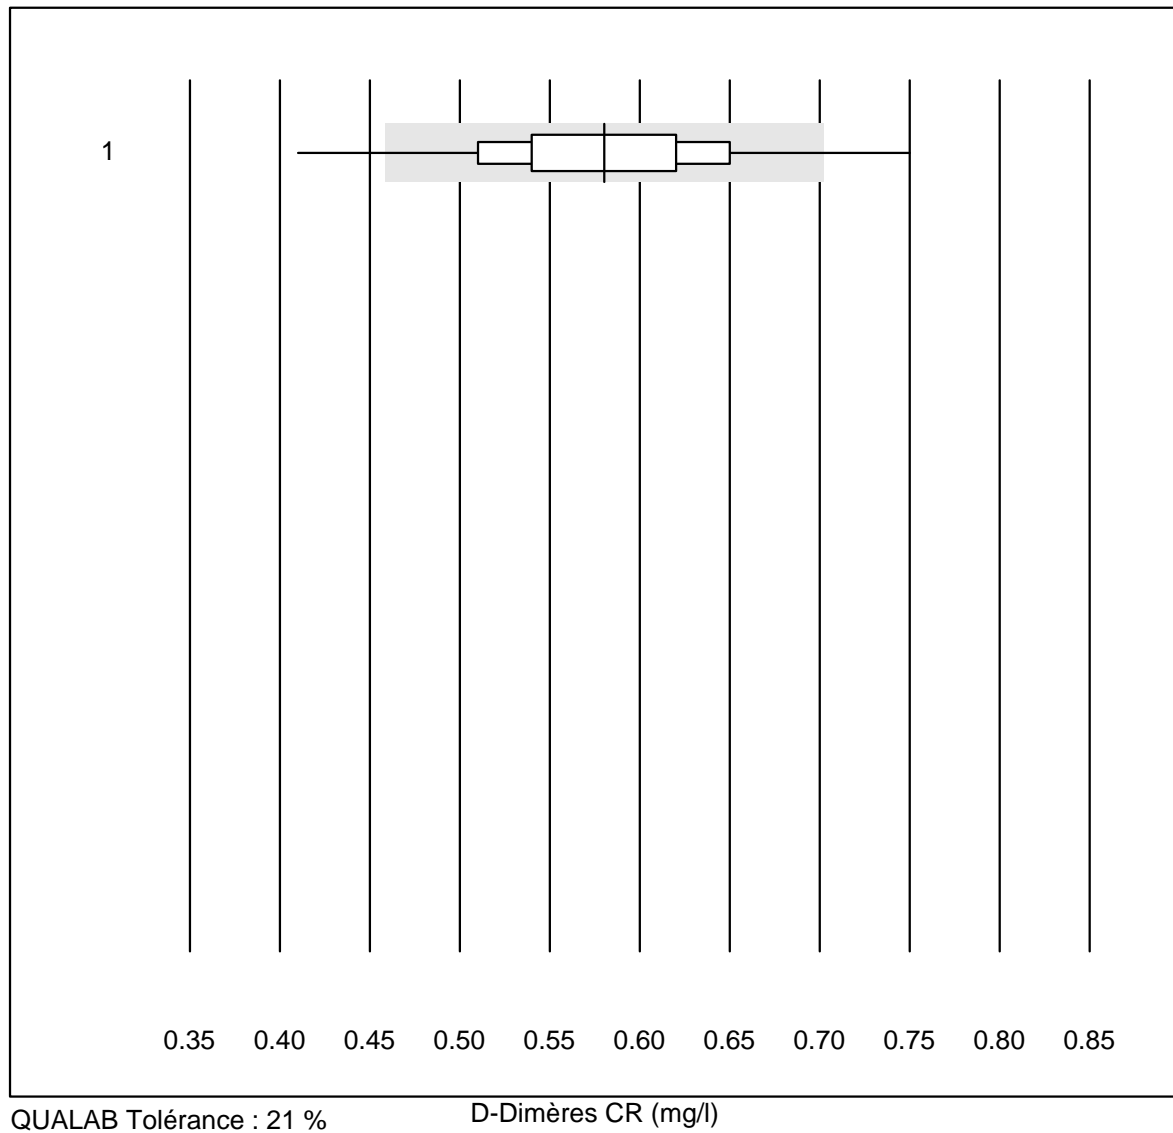


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas h 232	1259	95.5	2.9	1.6	0.58	9.8	e

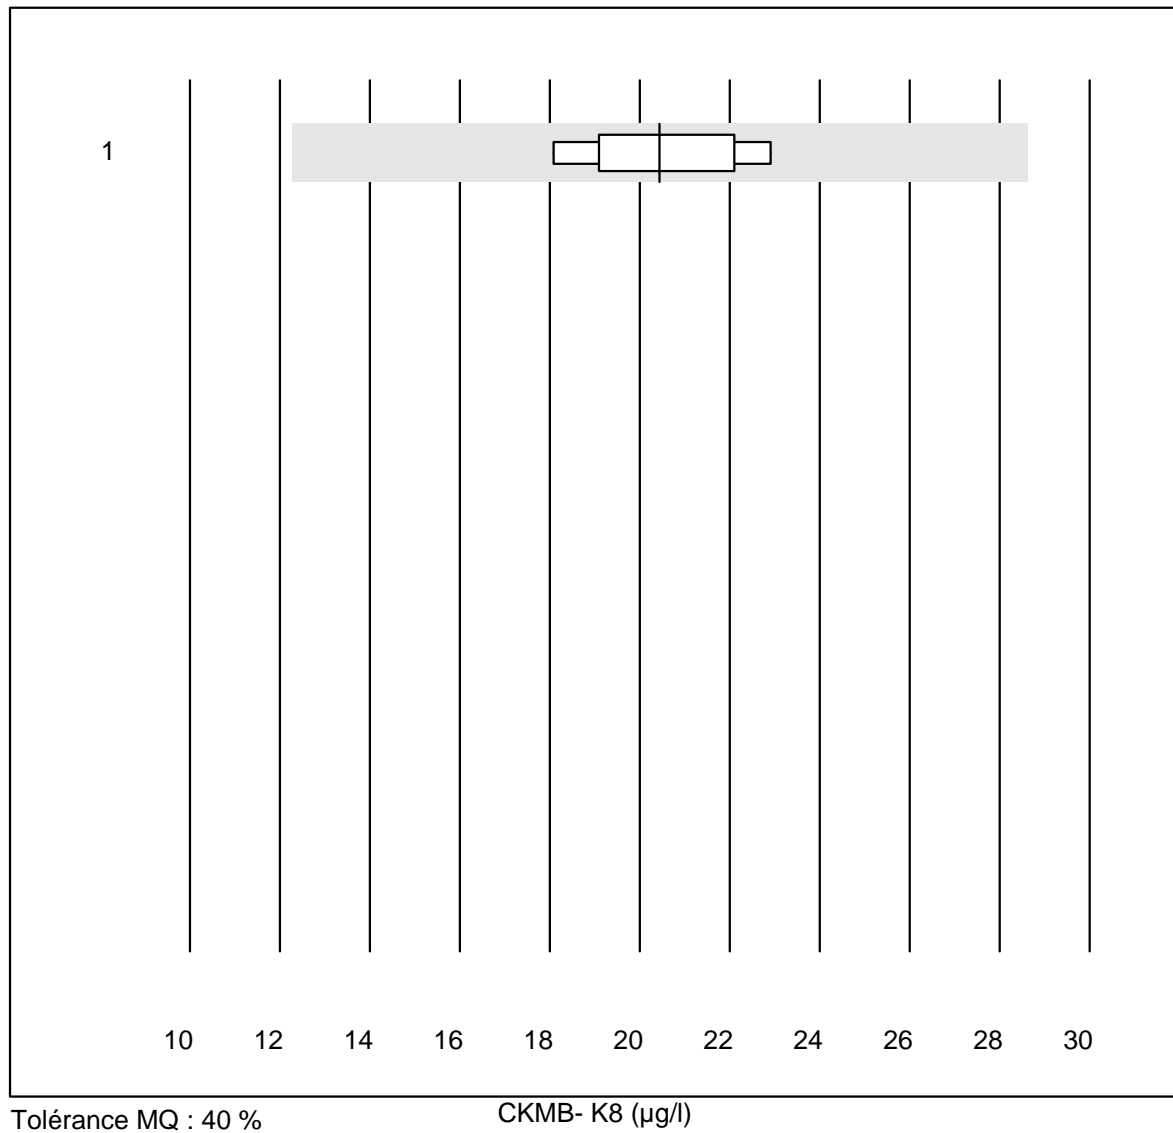CKMB- K8


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas h 232	9	100.0	0.0	0.0	20.4	8.6	e

NT-proBNP CR

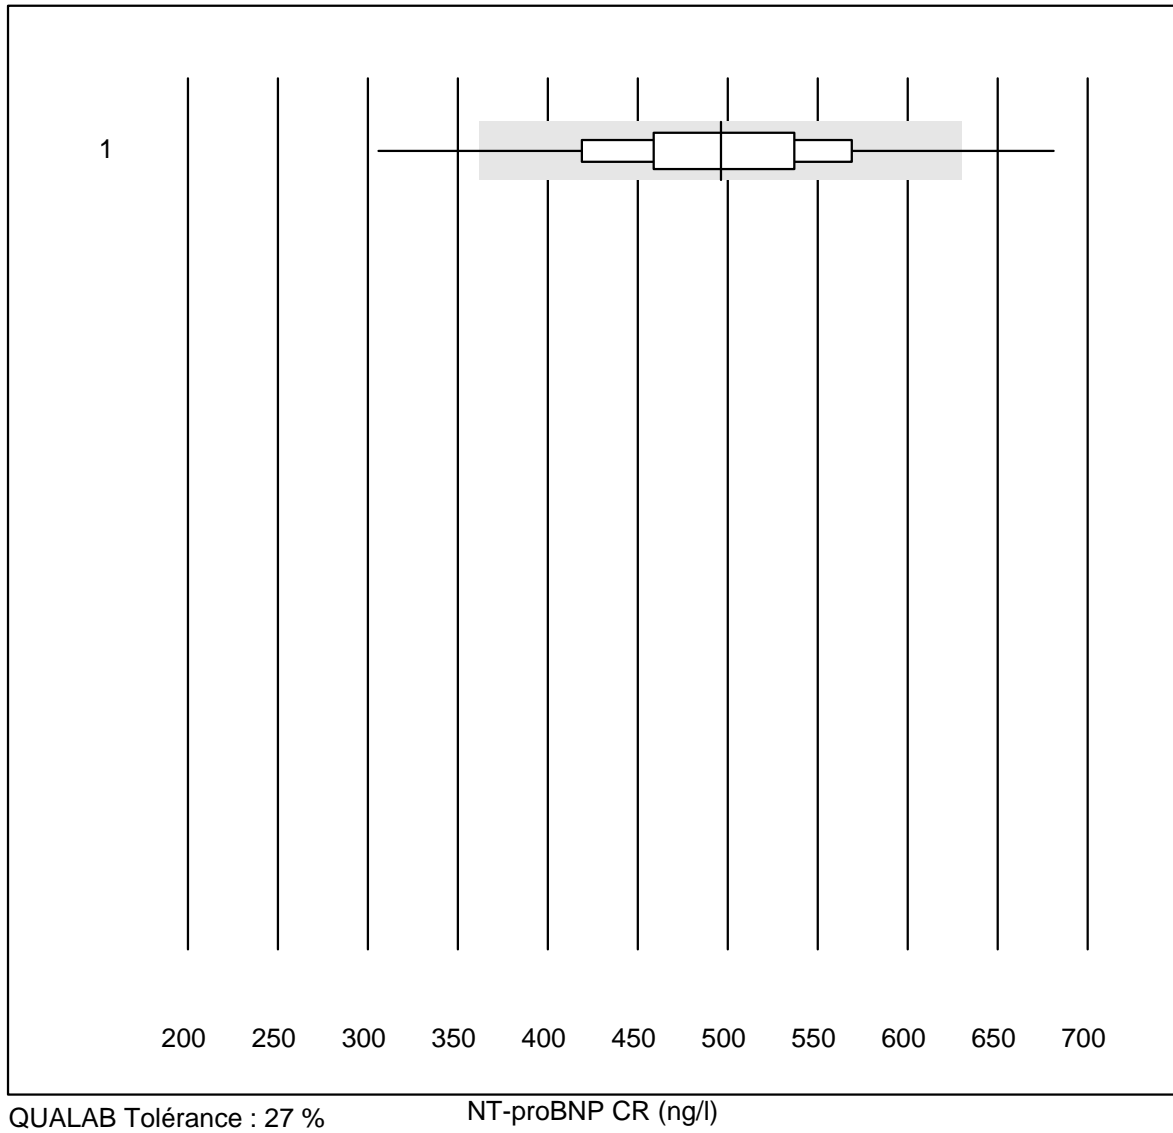

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas h 232	668	96.9	2.1	1.0	496	11.7	e

PCO2 CCA

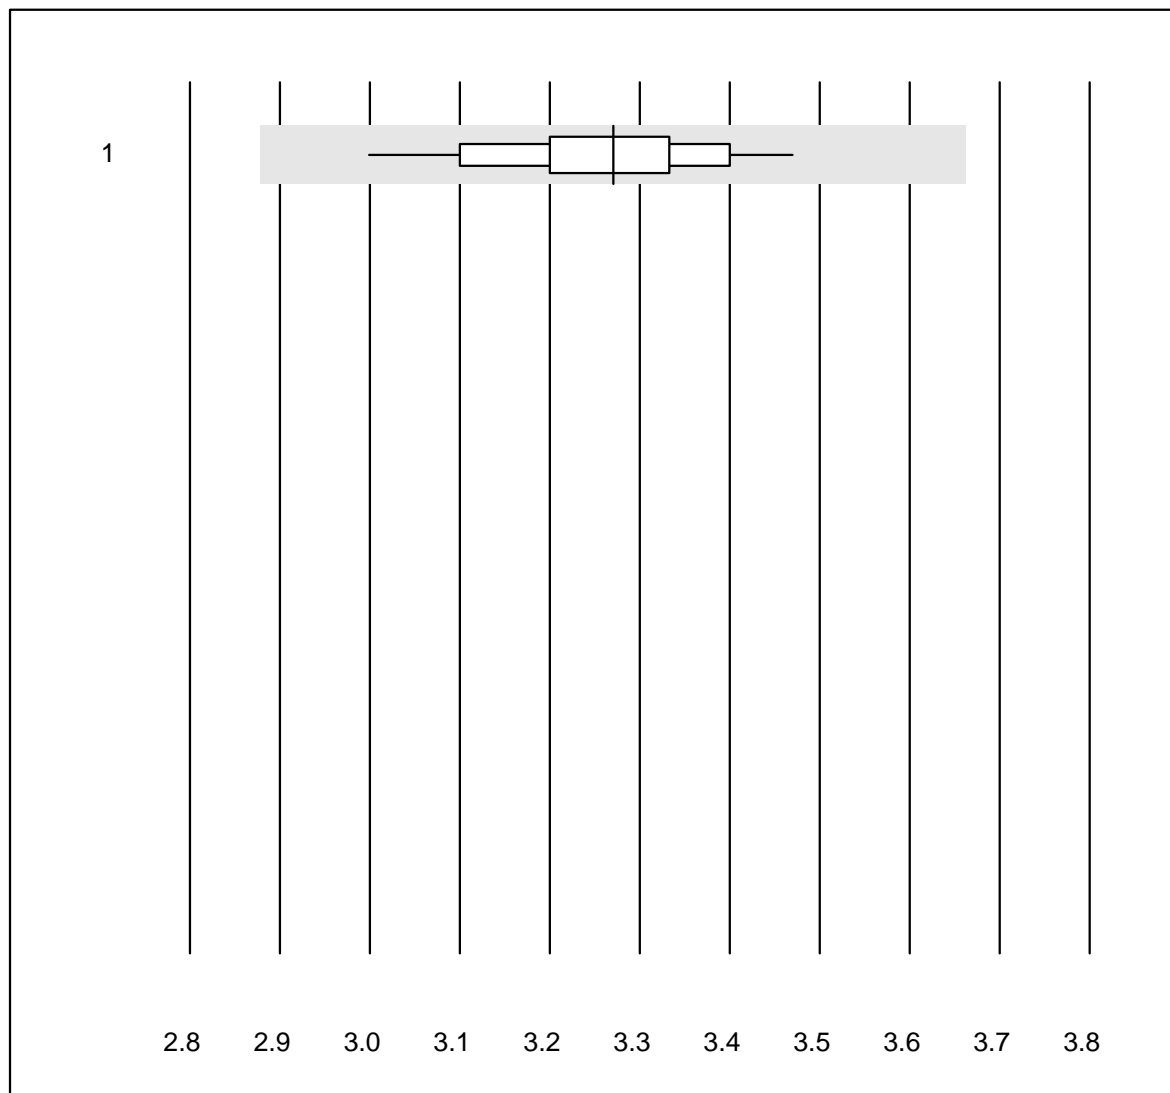


QUALAB Tolérance : 12 %

PCO2 CCA (kPa)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 OPTI CCA	11	100.0	0.0	0.0	3.27	4.1	e

PO2 CCA

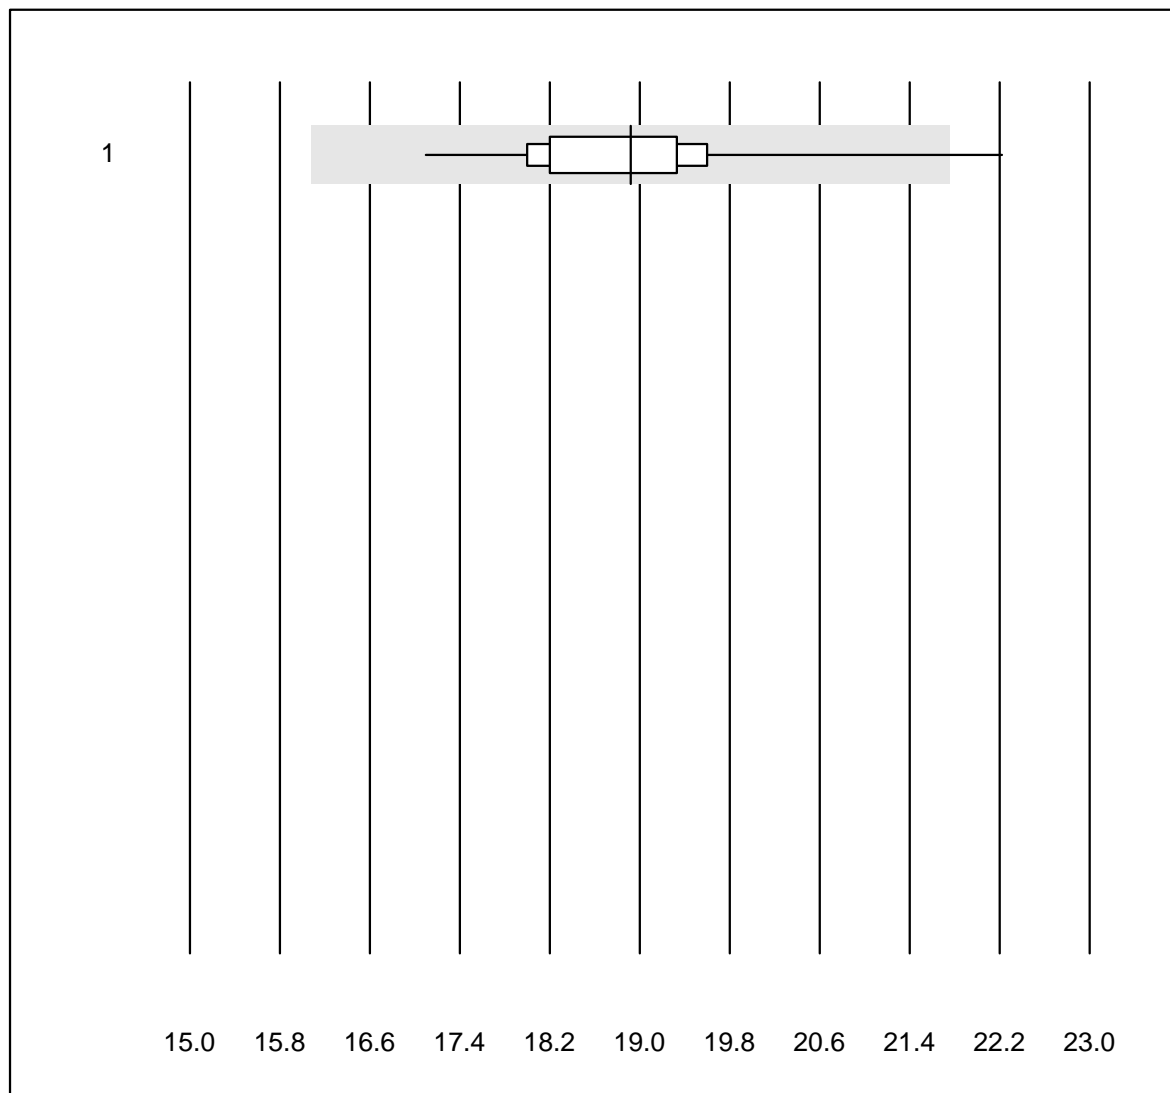


QUALAB Tolérance : 15 %

PO2 CCA (kPa)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 OPTI CCA	11	90.9	9.1	0.0	18.92	6.8	e*

pH CCA

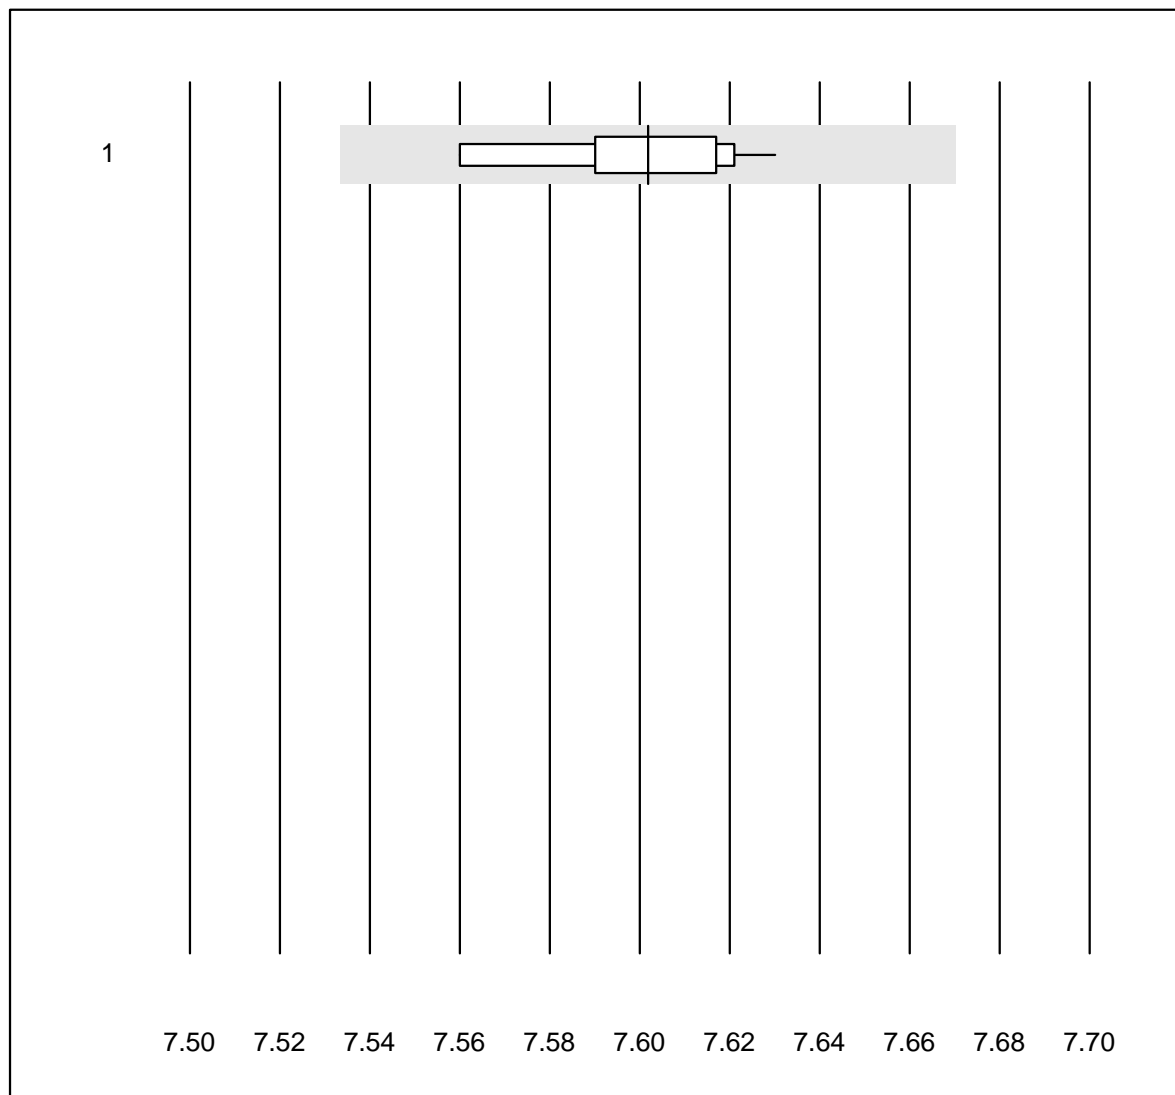


QUALAB Tolérance : 1 %

pH CCA ()

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 OPTI CCA	10	100.0	0.0	0.0	7.60	0.3	e

Potassium CCA

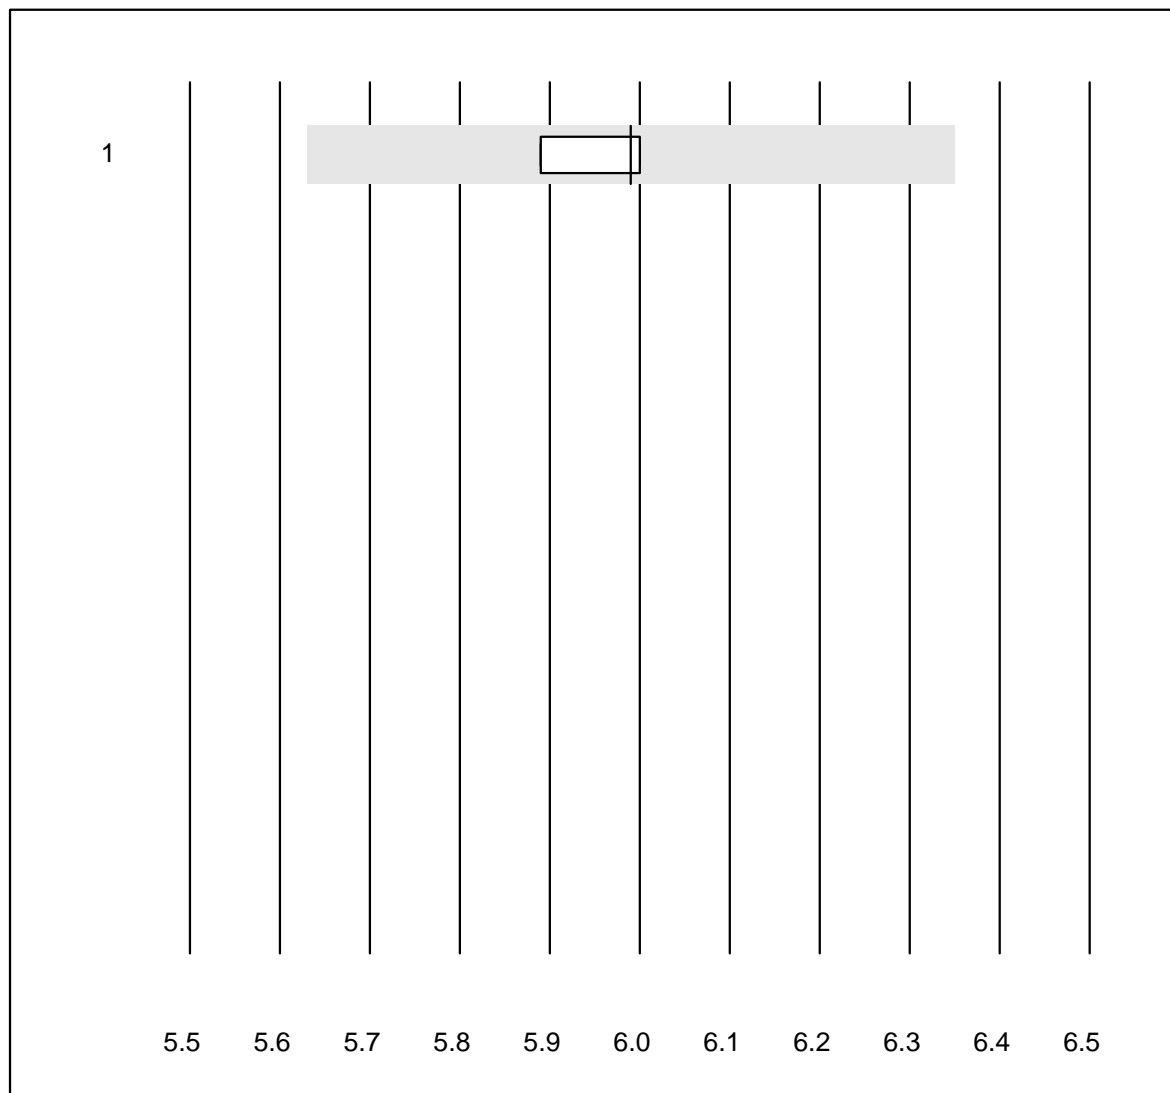


QUALAB Tolérance : 6 %

Potassium CCA (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 OPTI CCA	5	80.0	0.0	20.0	6.0	0.9	e

Sodium CCA

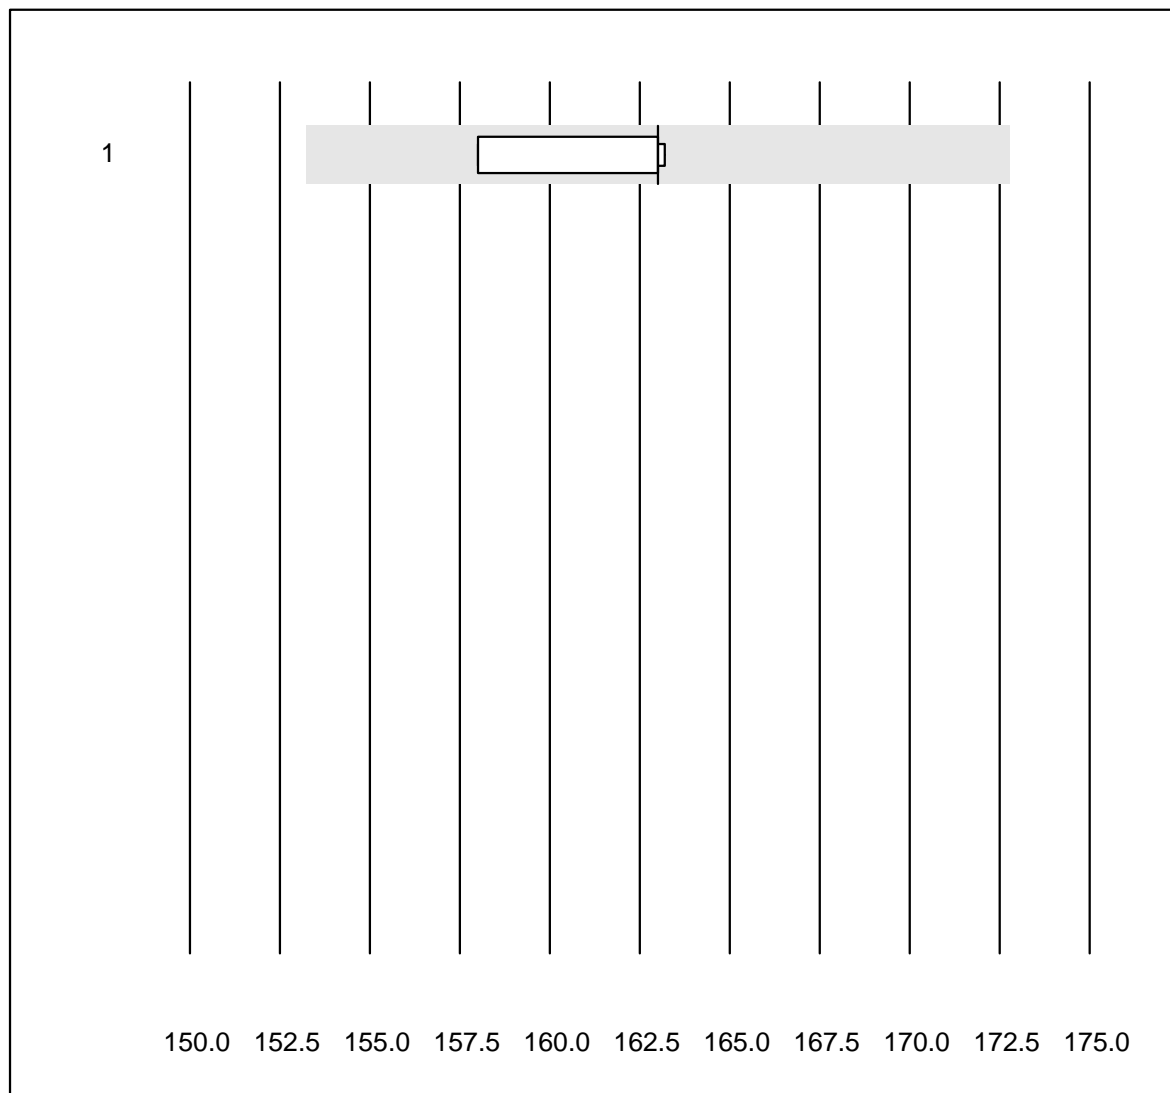


QUALAB Tolérance : 6 %

Sodium CCA (mmol/l)


No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 OPTI CCA	4	100.0	0.0	0.0	163.0	1.6	e*

Ferritine

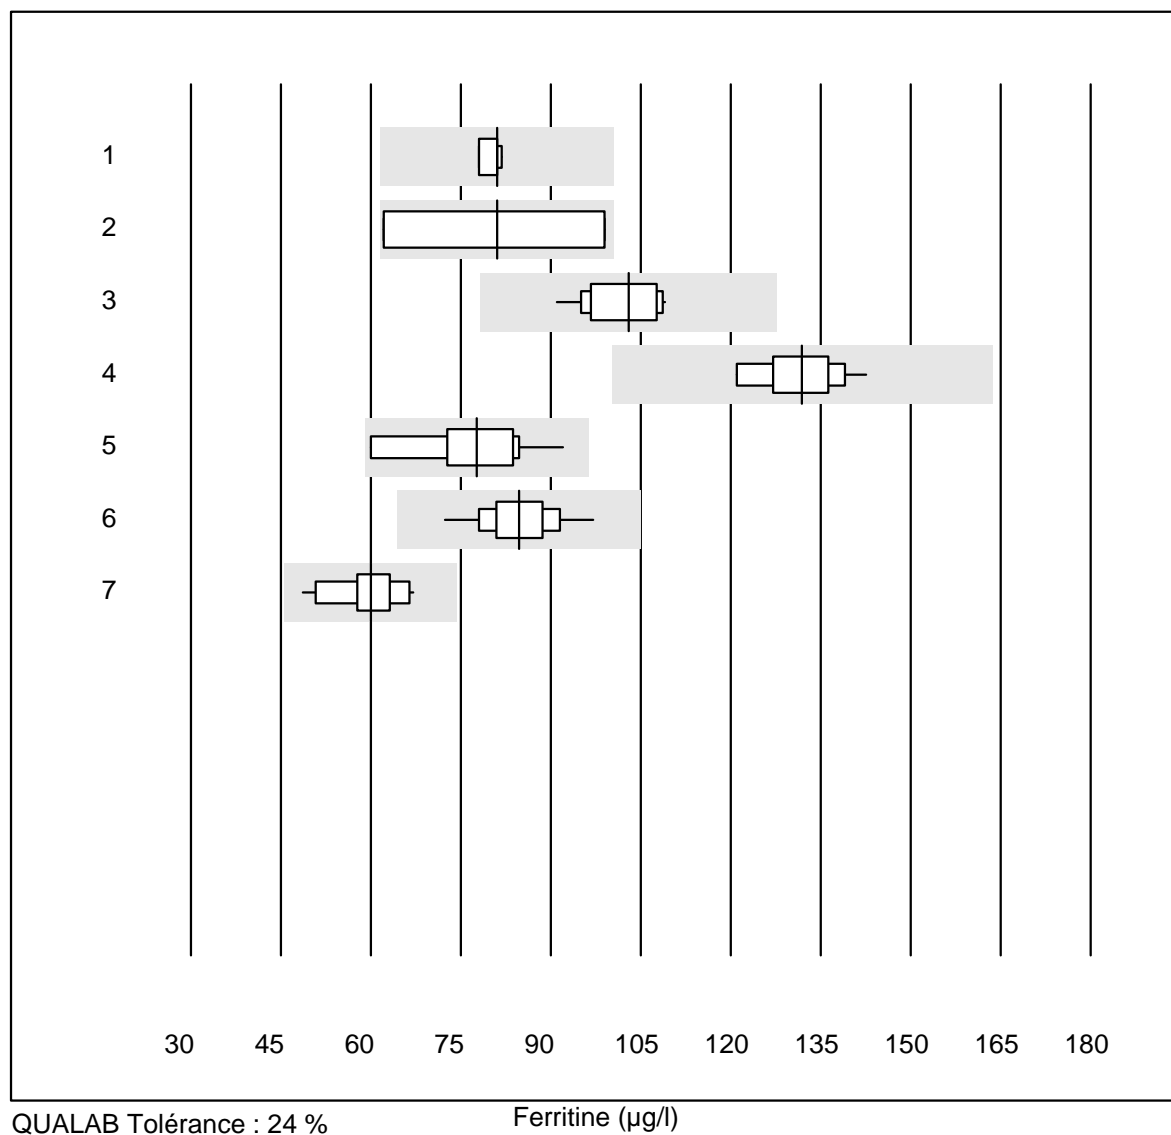

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Beckman	4	100.0	0.0	0.0	81.00	2.1	e
2 toutes les méthodes	4	75.0	0.0	25.0	81.00	22.7	a
3 Cobas E / Elecsys	16	100.0	0.0	0.0	103.01	5.6	e
4 Architect	11	90.9	0.0	9.1	131.90	5.0	e
5 Mini Vidas	10	100.0	0.0	0.0	77.64	11.2	a
6 AFIAS	45	100.0	0.0	0.0	84.71	6.4	e
7 Eurolyser	19	84.2	0.0	15.8	59.98	8.4	e

Vitamine B12

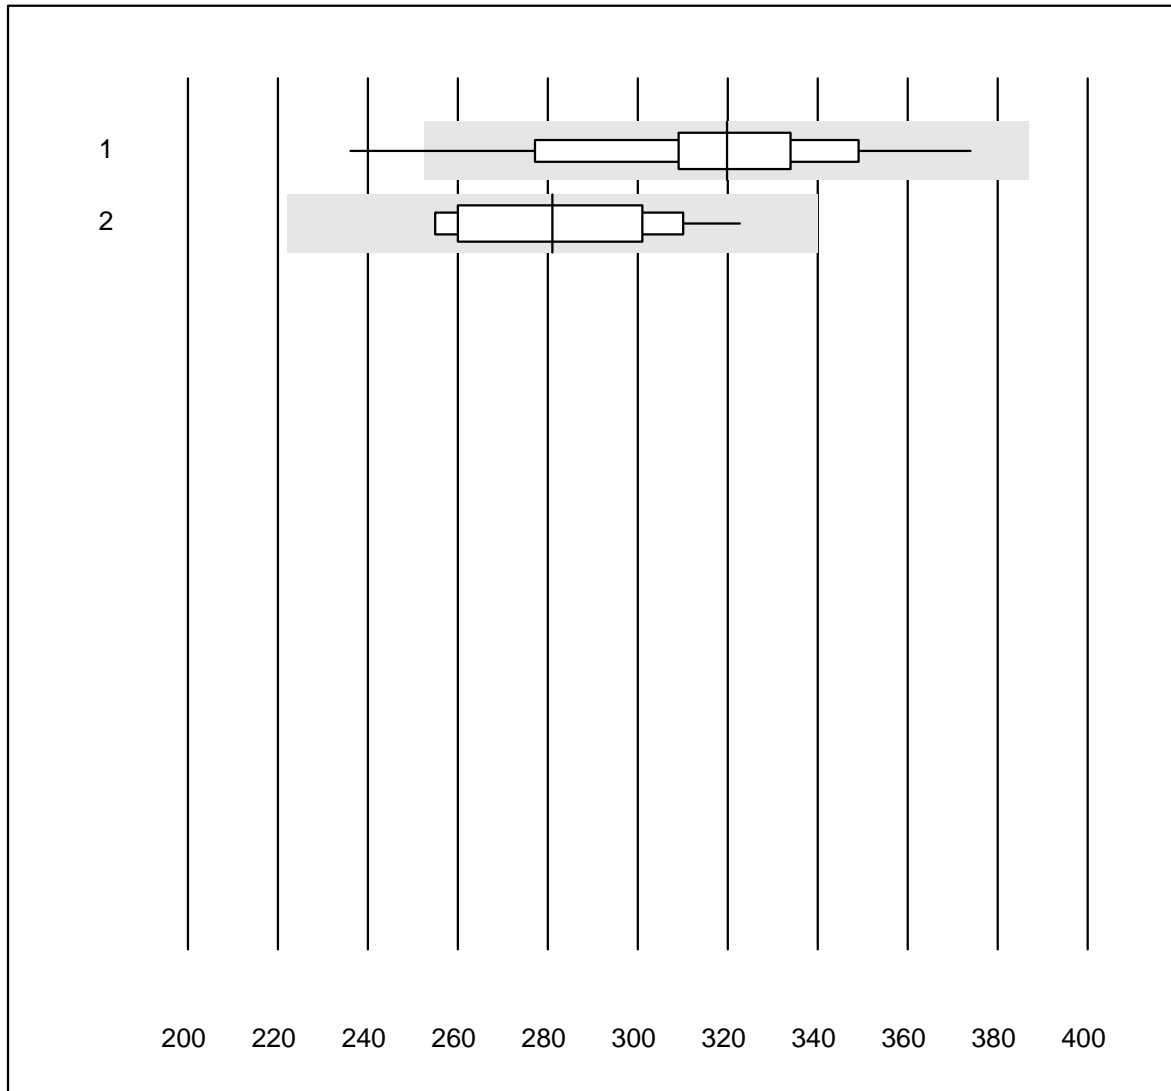


QUALAB Tolérance : 21 %

Vitamine B12 (pmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	14	92.9	7.1	0.0	319.81	10.3	e*
2 Architect	10	100.0	0.0	0.0	280.94	8.4	e*

Folate

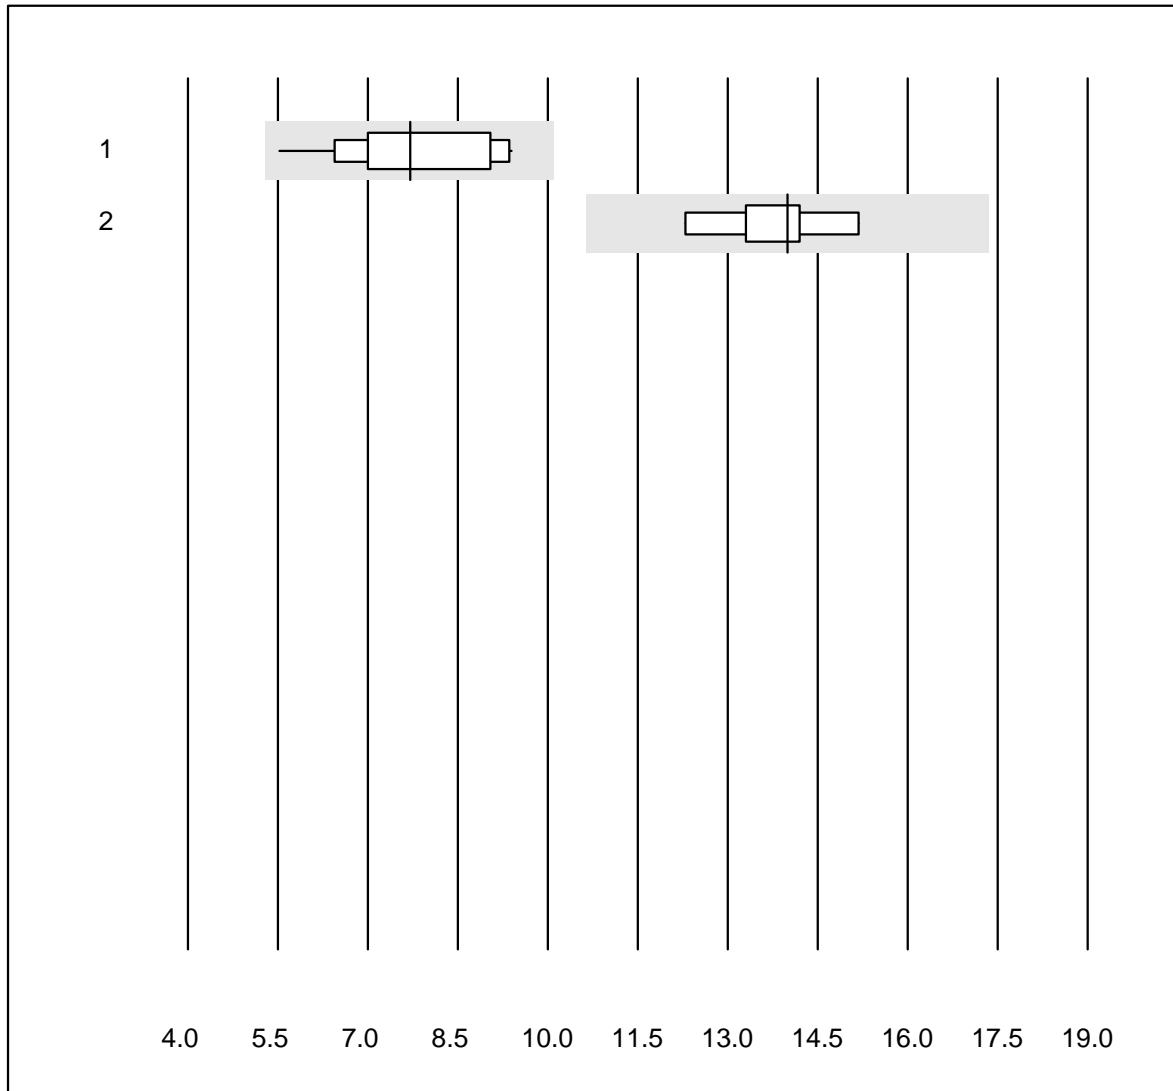


QUALAB Tolérance : 24 %
 (< 10.00: +/- 2.40 nmol/l)

Folate (nmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	17	100.0	0.0	0.0	7.70	14.6	e*
2 Architect	9	100.0	0.0	0.0	14.00	6.8	e

Holotranscobalamine

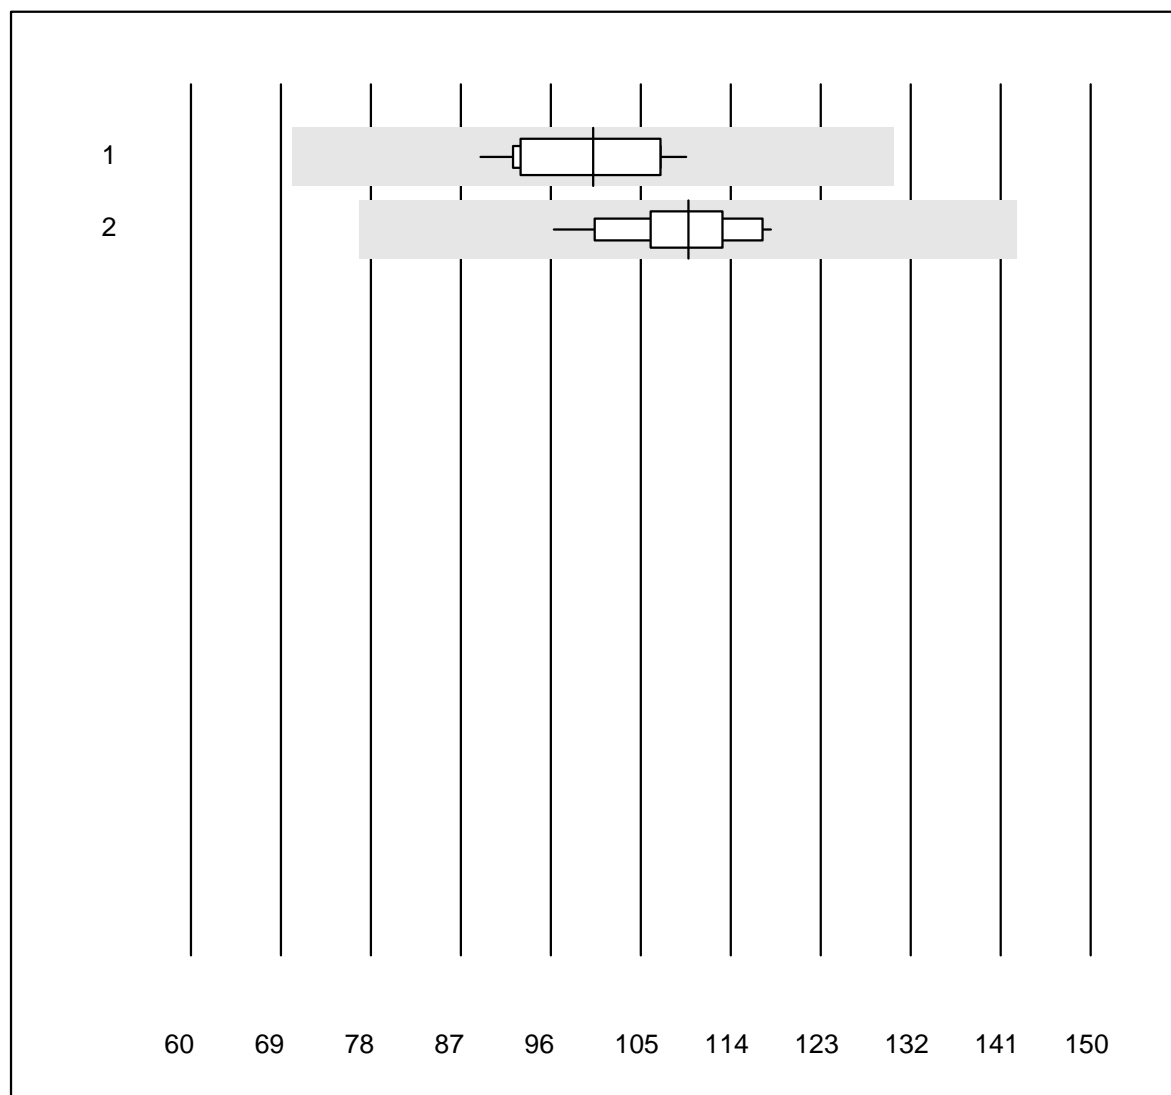


Tolérance MQ : 30 %

Holotranscobalamine (pmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Architect	11	100.0	0.0	0.0	100.2	7.4	e
2 toutes les méthodes	19	100.0	0.0	0.0	109.8	5.2	e

Bilirubin totale Neo

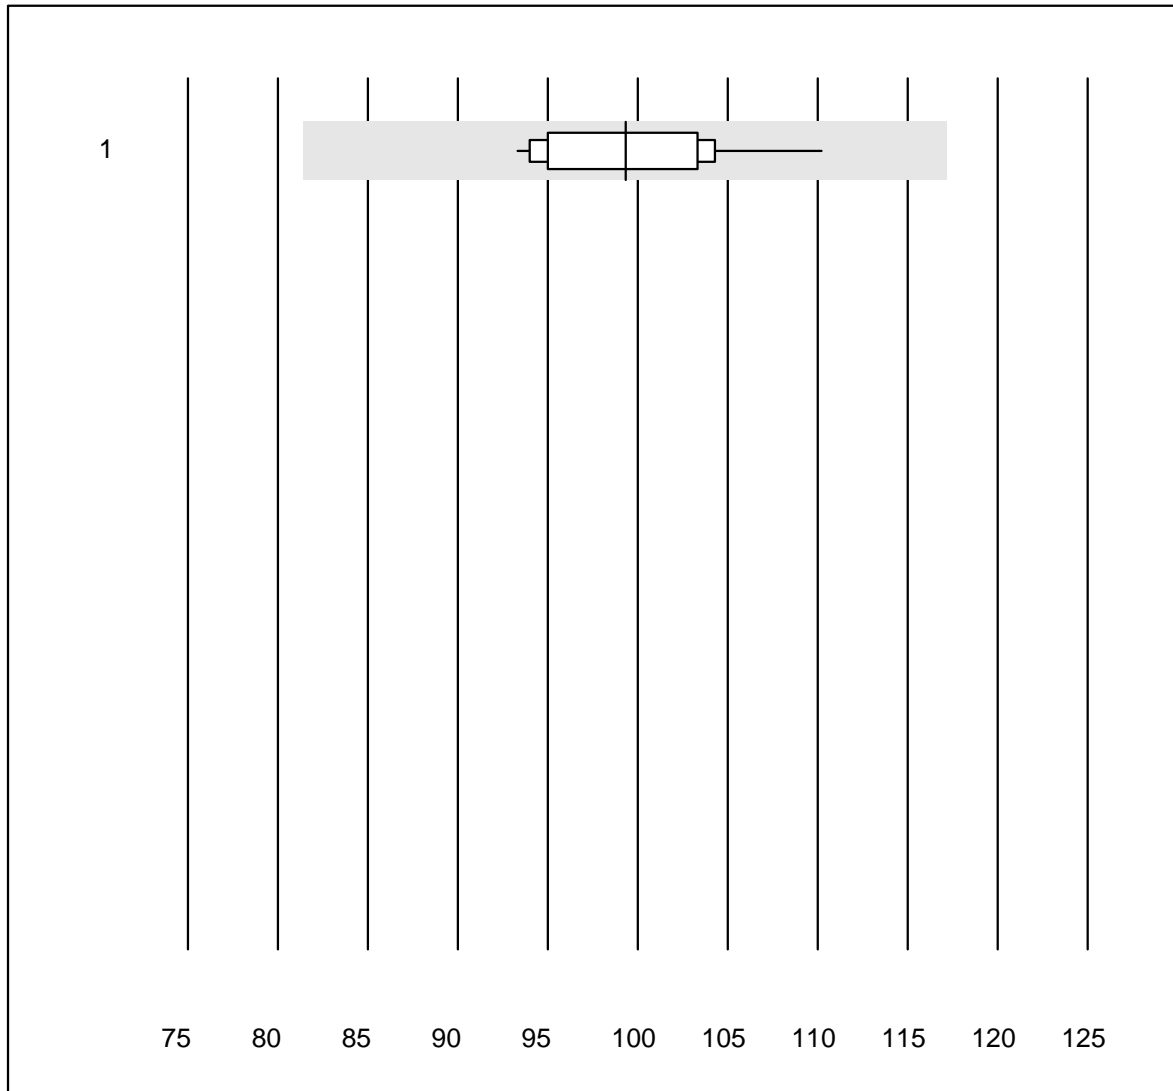


QUALAB Tolérance : 18 %

Bilirubin totale Neo ($\mu\text{mol/l}$)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	toutes les méthodes	12	100.0	0.0	0.0	99	5.4	e

Bilirubin directe

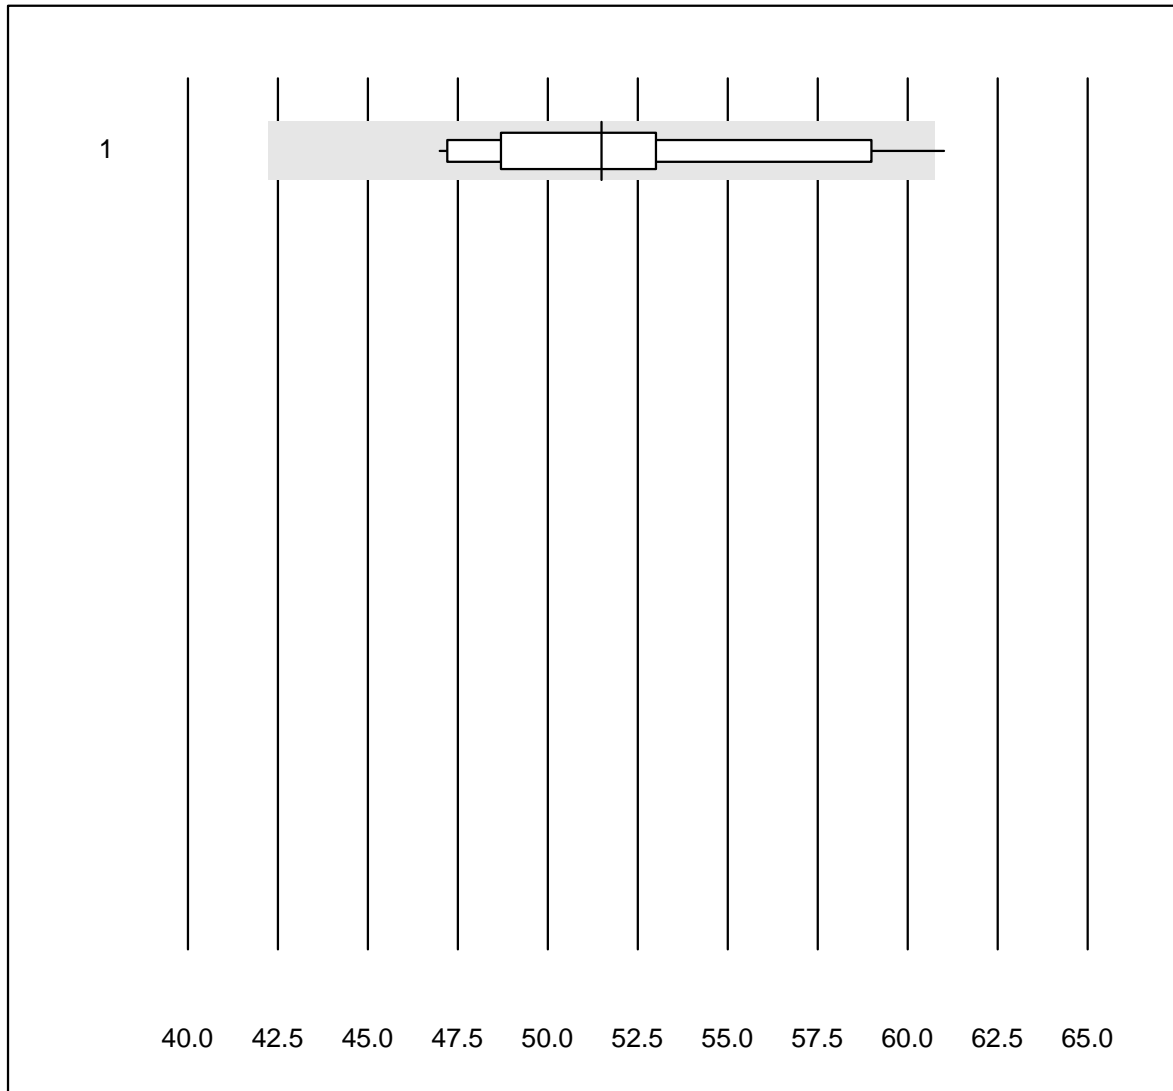


QUALAB Tolérance : 18 %

Bilirubin directe (µmol/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	14	92.9	7.1	0.0	51	8.1	e*

Bilirubin néonatale

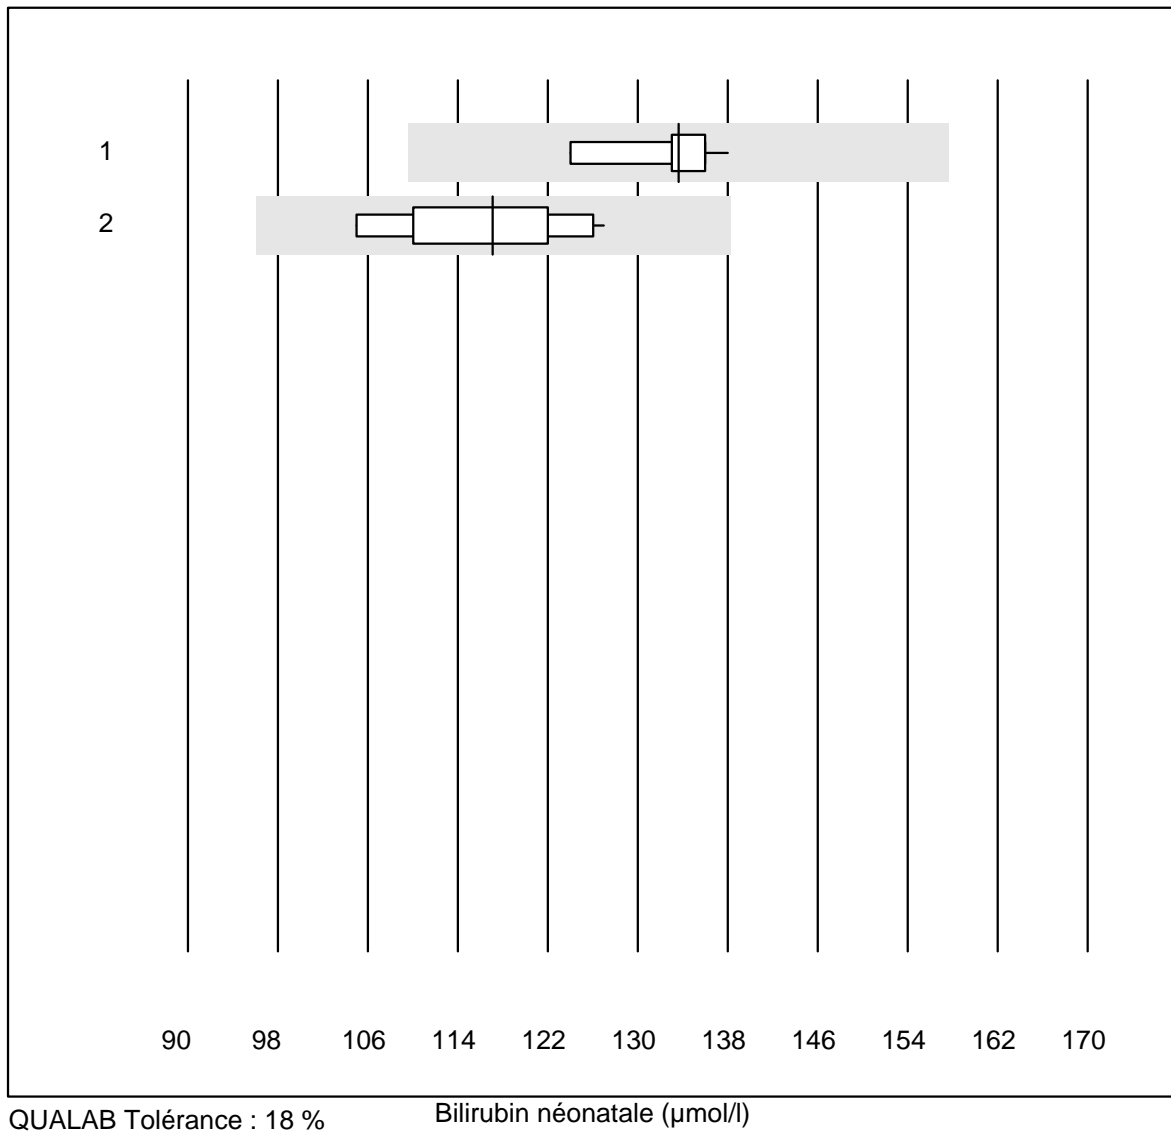

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	10	100.0	0.0	0.0	134	3.0	e
2 ABL700/800	10	100.0	0.0	0.0	117	6.8	e*

PSA

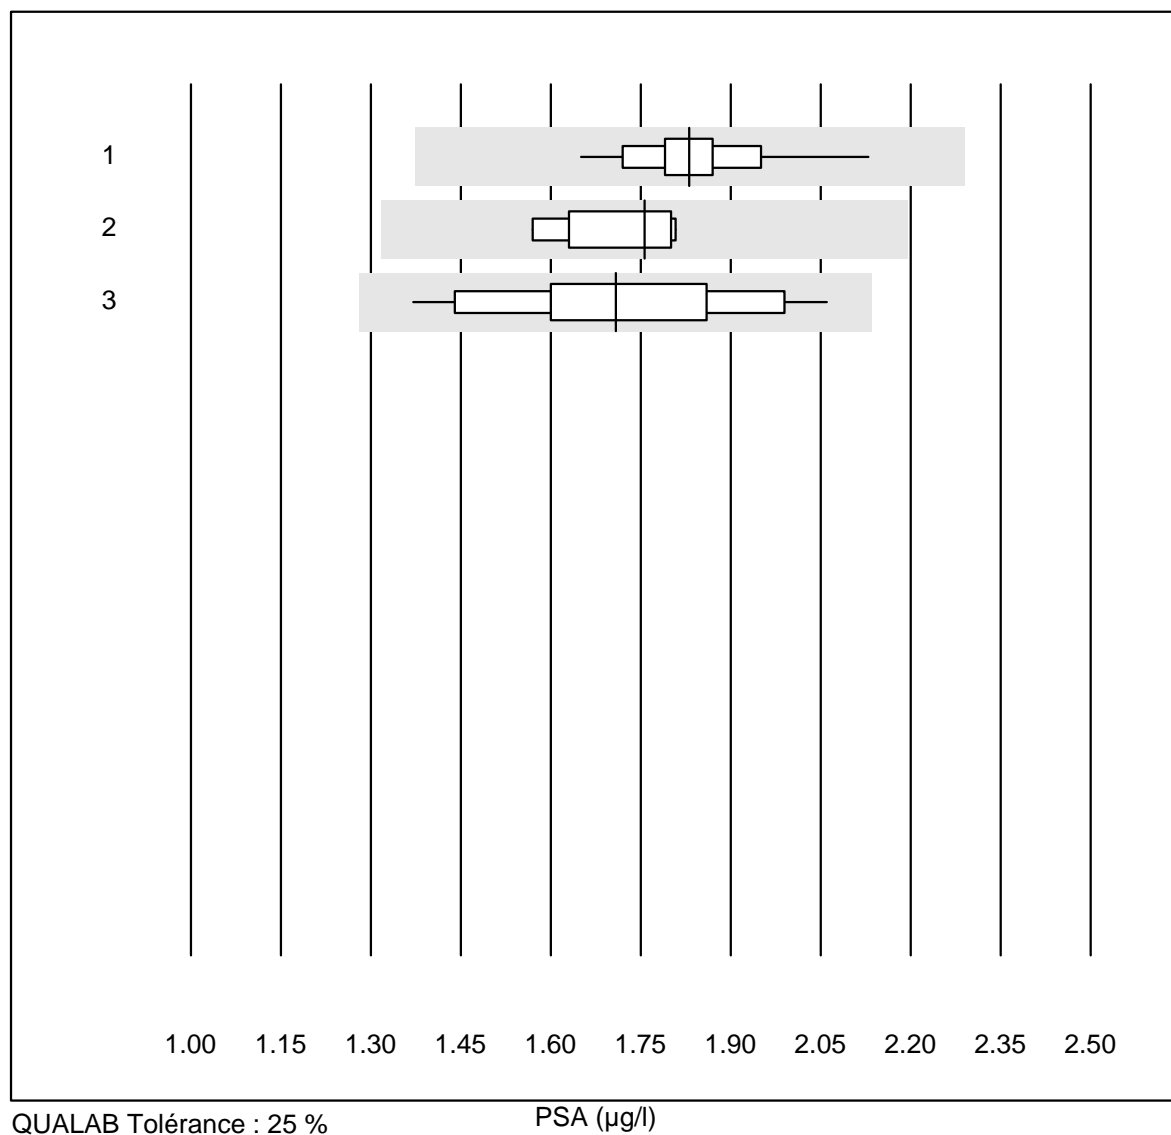


QUALAB Tolérance : 25 %

PSA (µg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	16	100.0	0.0	0.0	1.83	5.8	e
2 Architect	7	100.0	0.0	0.0	1.76	5.0	a
3 AFIAS	31	100.0	0.0	0.0	1.71	11.2	e

PSA frei

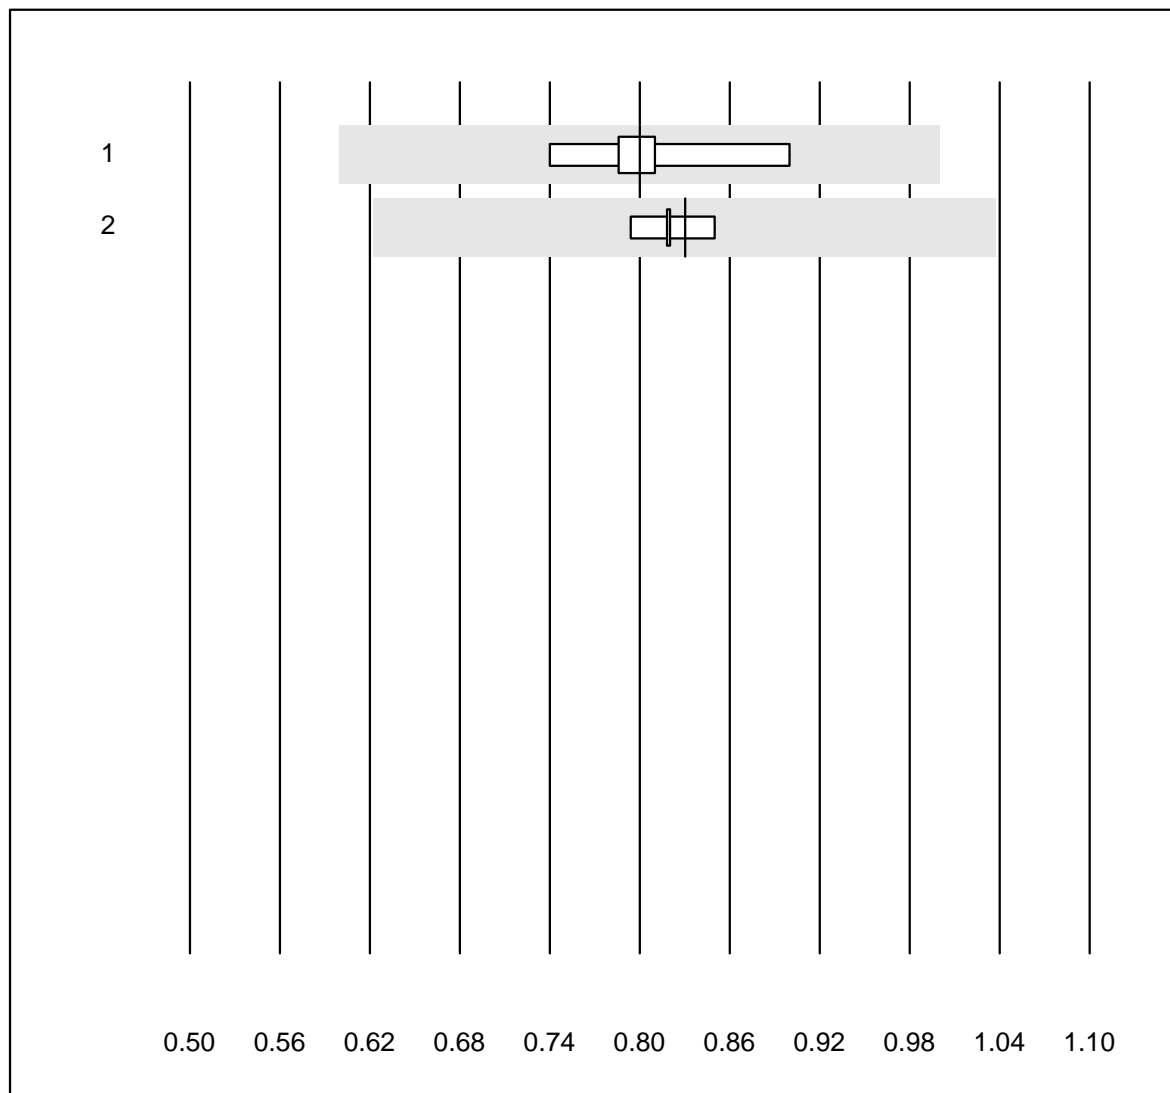


QUALAB Tolérance : 25 %

PSA frei (µg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	9	100.0	0.0	0.0	0.80	6.0	e
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	0.83	2.4	a

CEA

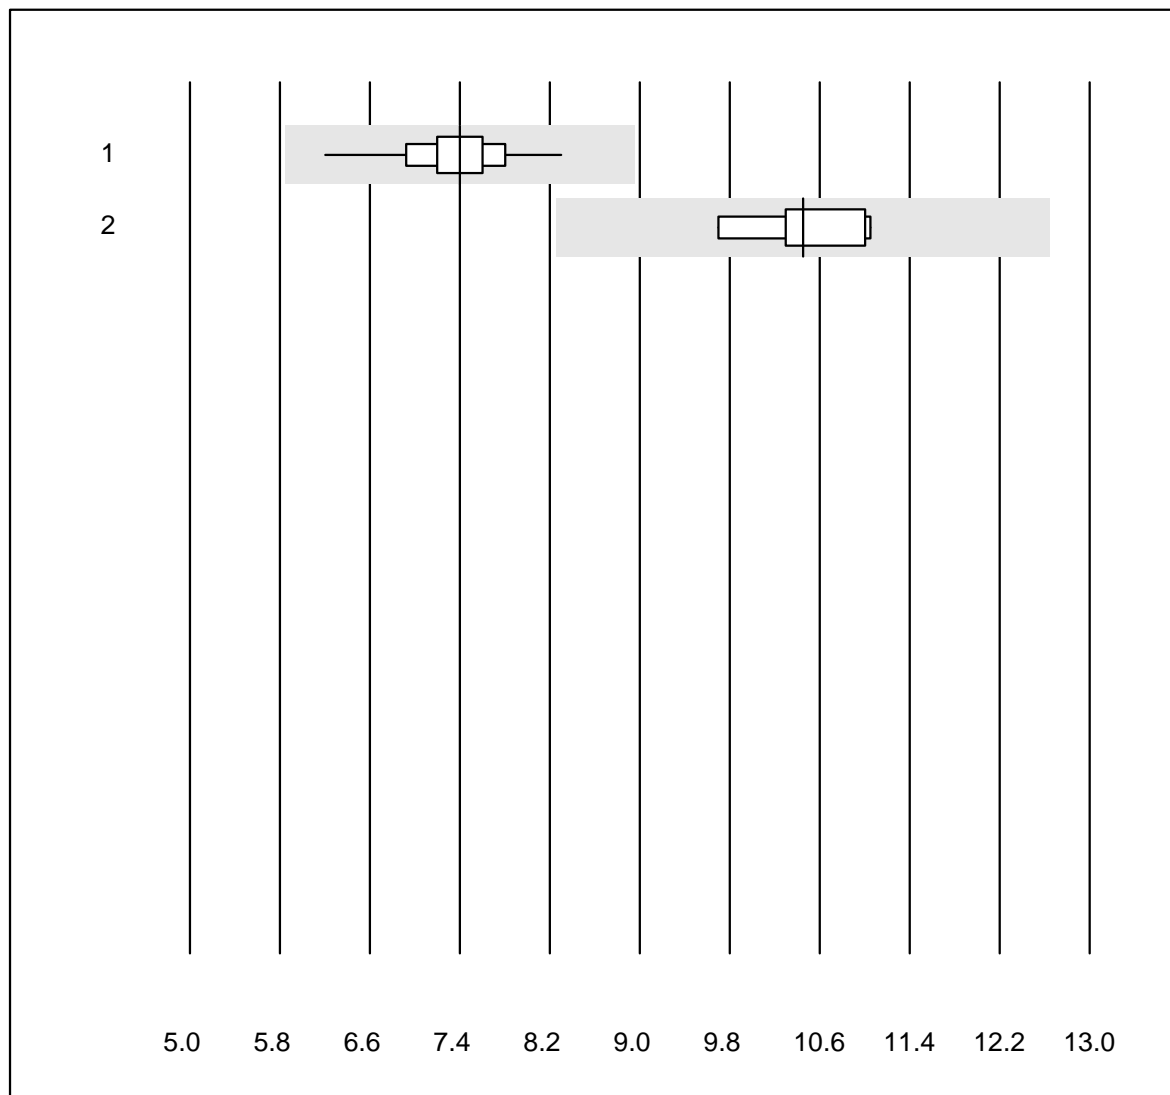


QUALAB Tolérance : 21 %

CEA (µg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	13	100.0	0.0	0.0	7.4	6.8	e
2 Architect	6	100.0	0.0	0.0	10.5	4.8	e

CA 125

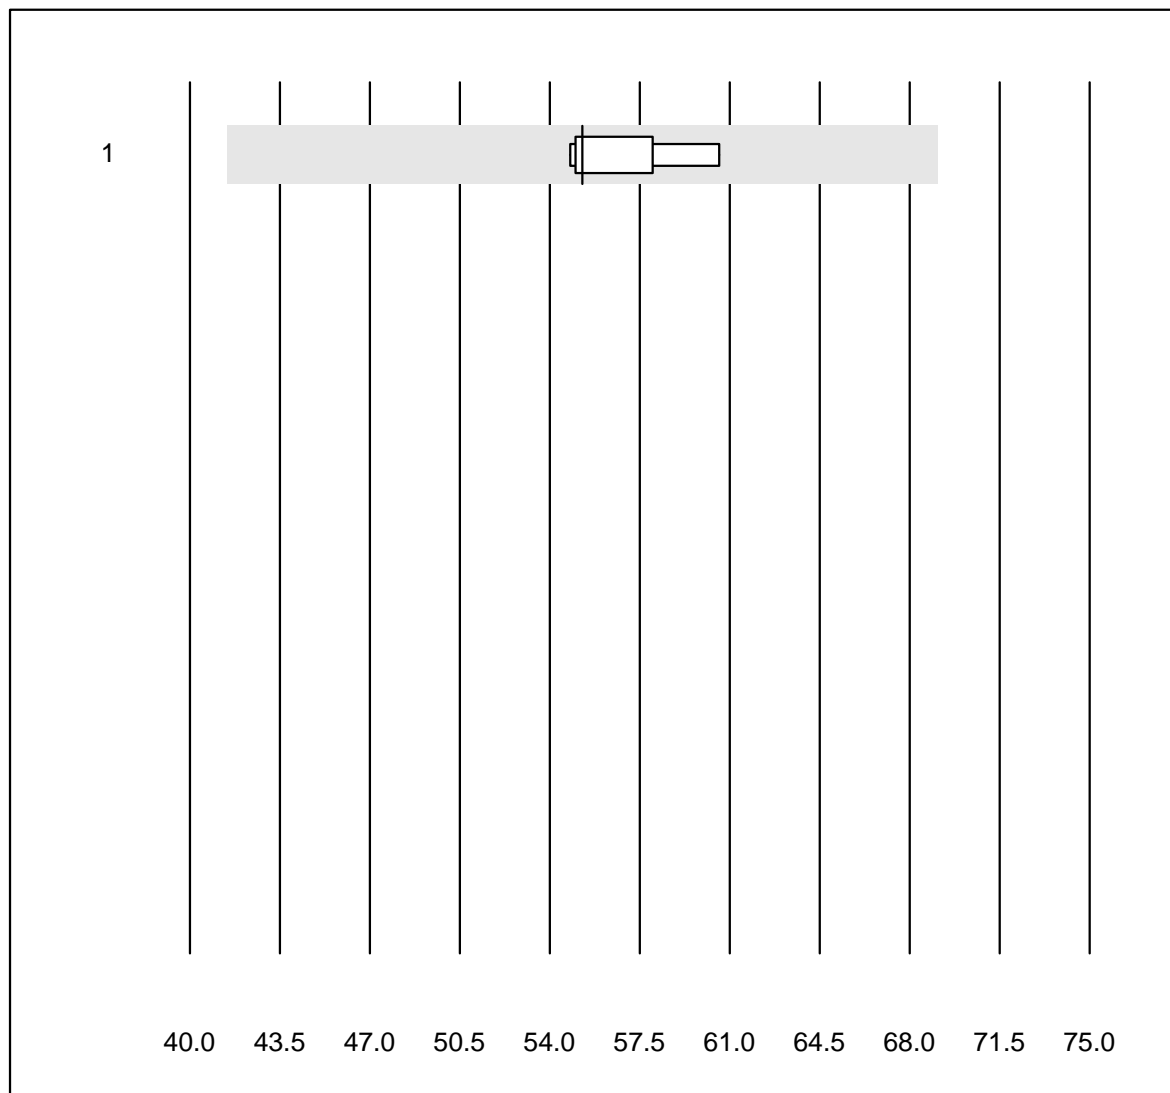


Tolérance MQ : 25 %

CA 125 (kIU/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	7	100.0	0.0	0.0	55.3	3.6	a

CA 19-9

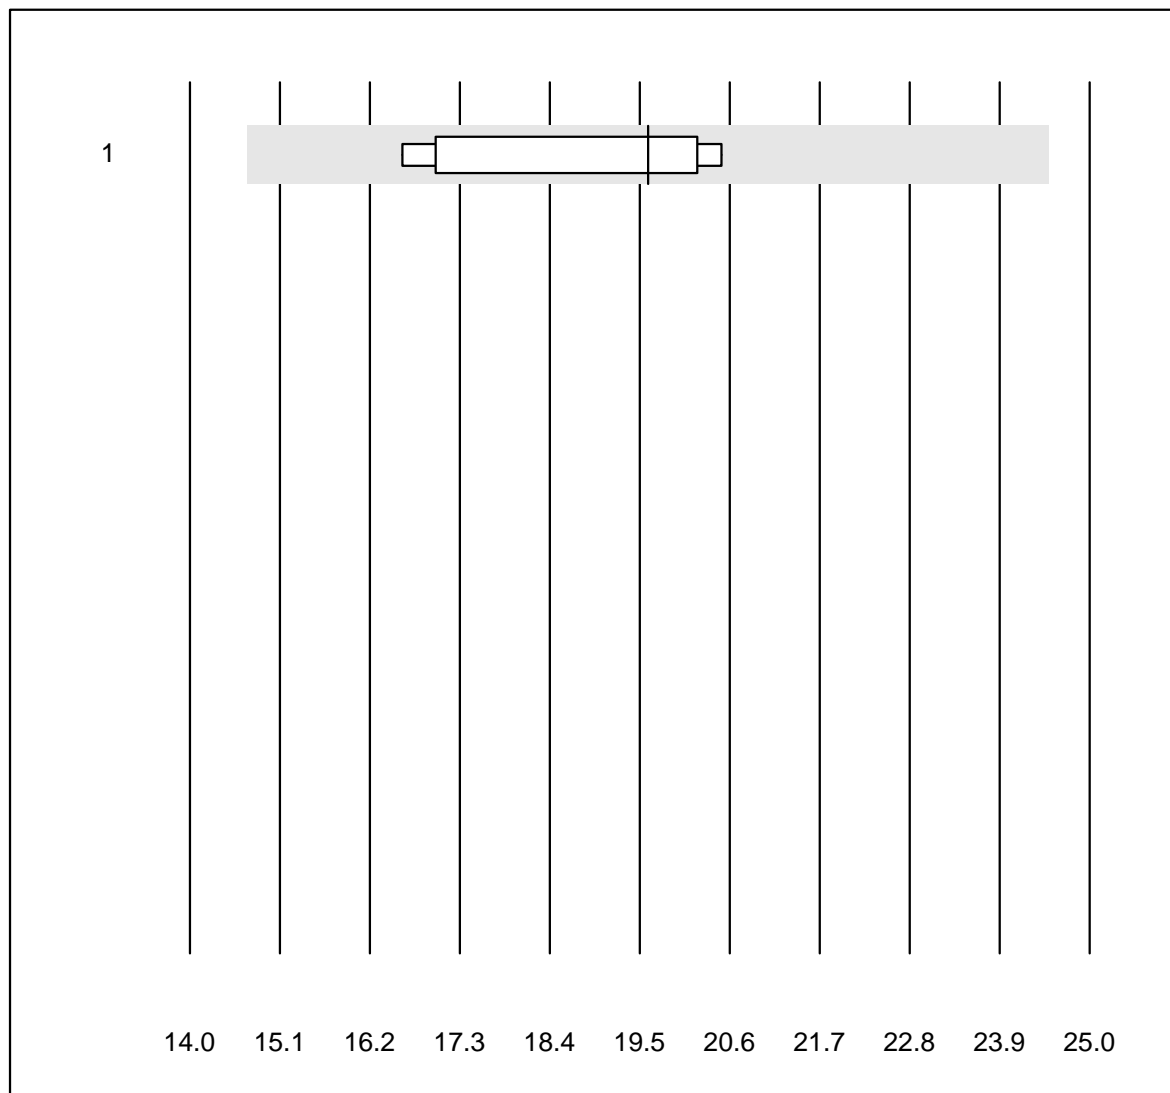


Tolérance MQ : 25 %

CA 19-9 (kIU/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	7	100.0	0.0	0.0	19.6	8.1	e*

CA 15-3

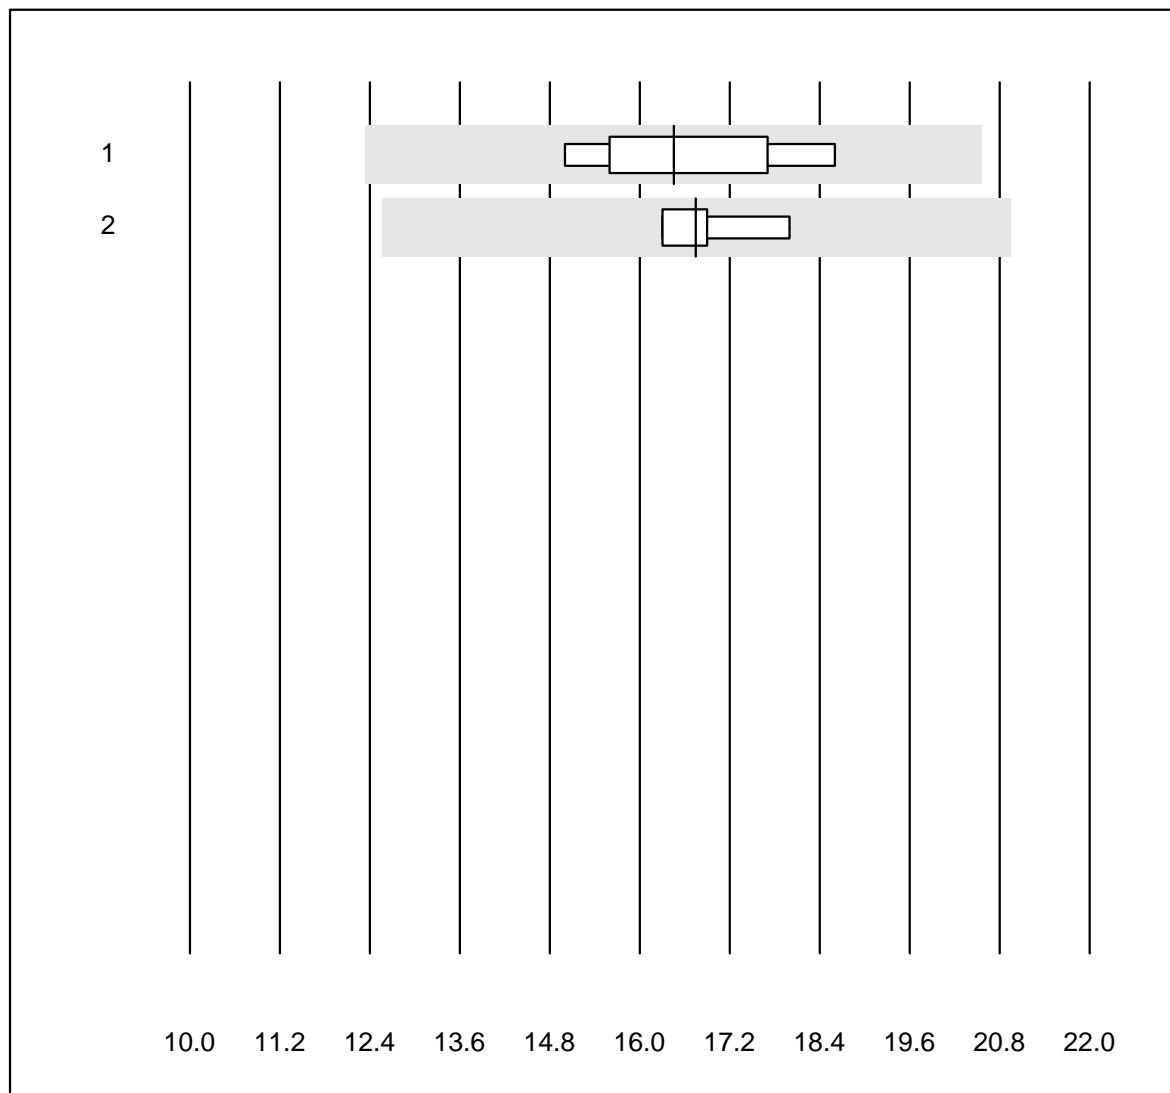


Tolérance MQ : 25 %

CA 15-3 (kIU/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	8	100.0	0.0	0.0	16.5	7.9	e
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	16.8	4.4	e

AFP

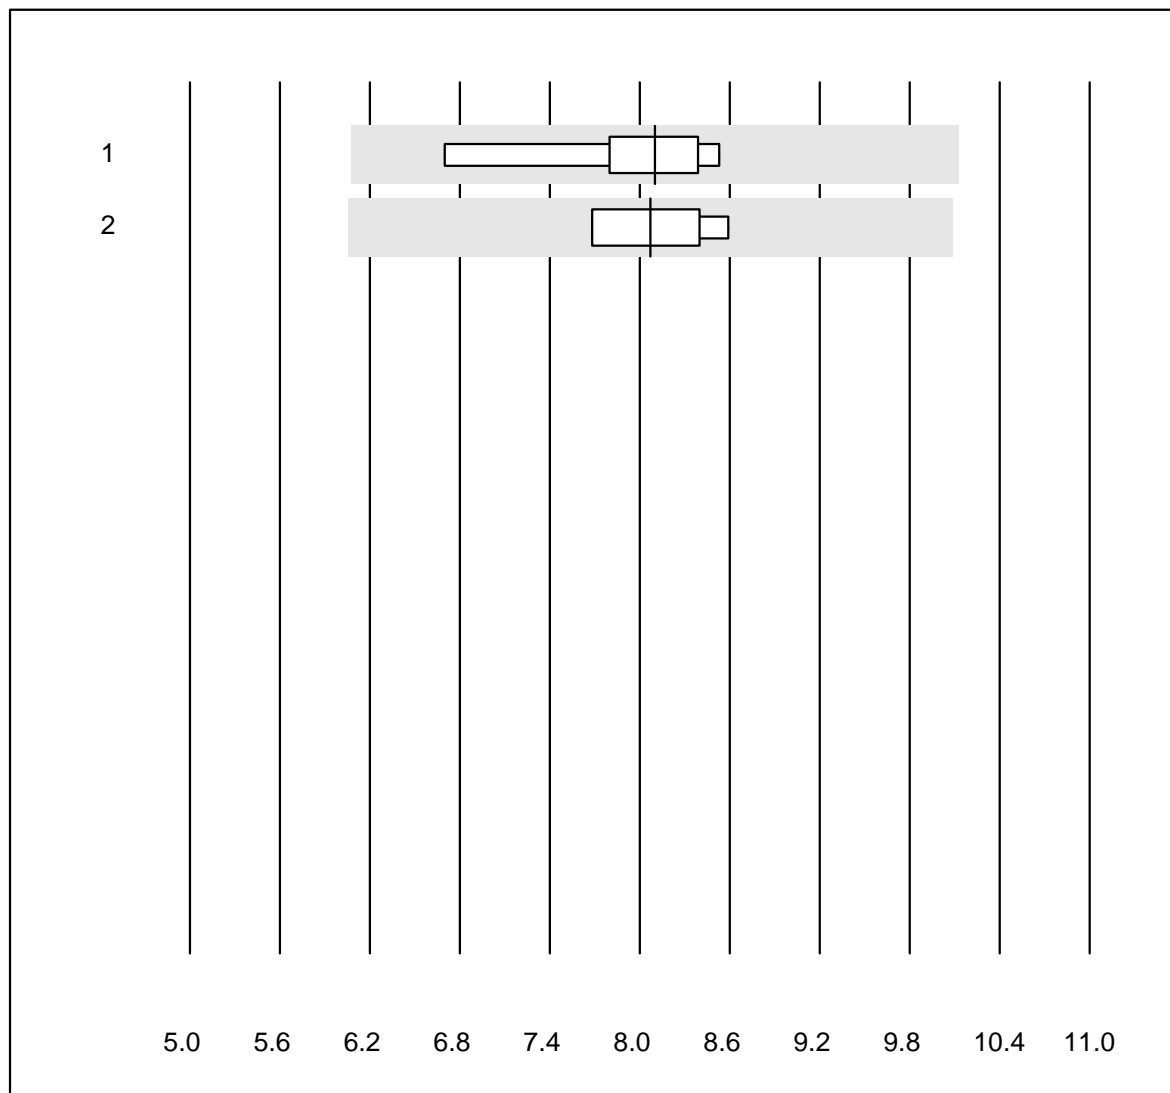


QUALAB Tolérance : 25 %

AFP (µg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	6	100.0	0.0	0.0	8.1	8.3	e*
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	8.1	4.8	a

HCG qn

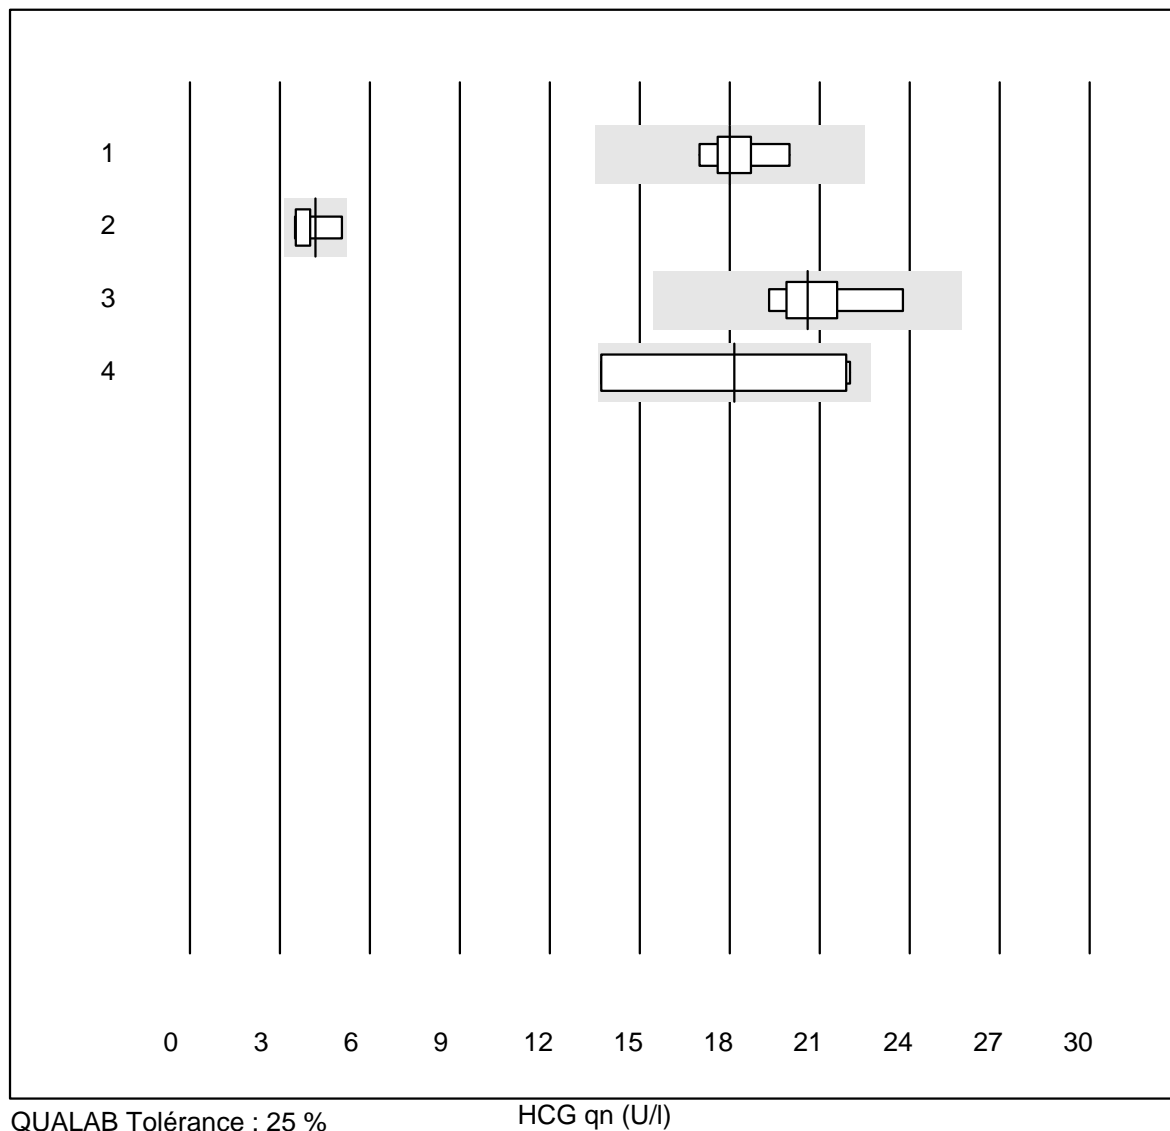


QUALAB Tolérance : 25 %

HCG qn (U/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	7	100.0	0.0	0.0	18.0	5.2	e
2 VIDAS	7	100.0	0.0	0.0	4.2	13.2	a
3 Architect	6	100.0	0.0	0.0	20.6	7.6	e*
4 AFIAS	6	66.7	0.0	33.3	18.2	24.3	a

HCG intakt

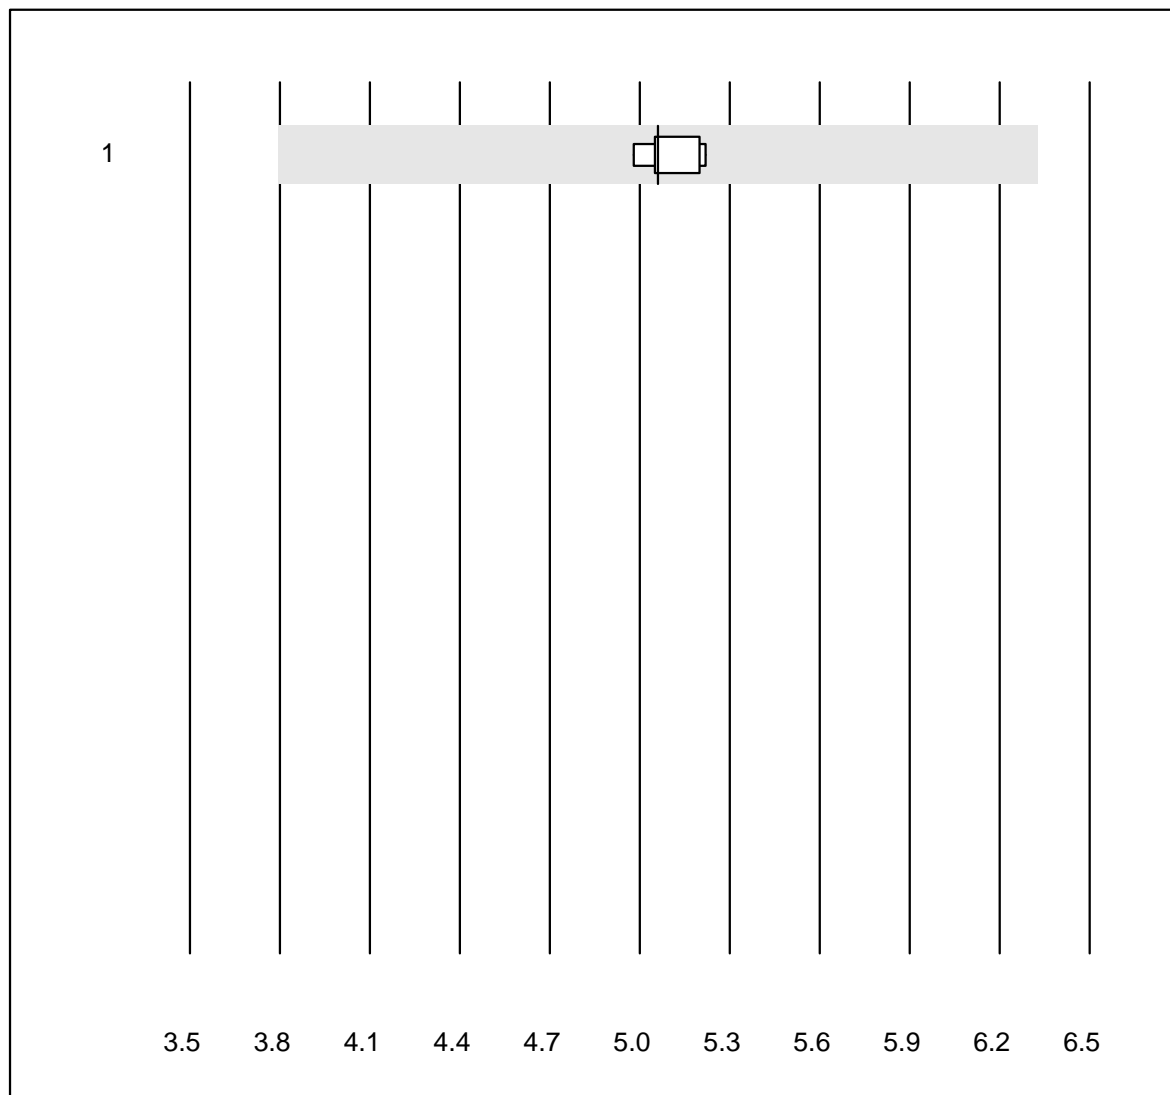


QUALAB Tolérance : 25 %

HCG intakt (U/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	5.1	2.0	e


Thyreoglobuline

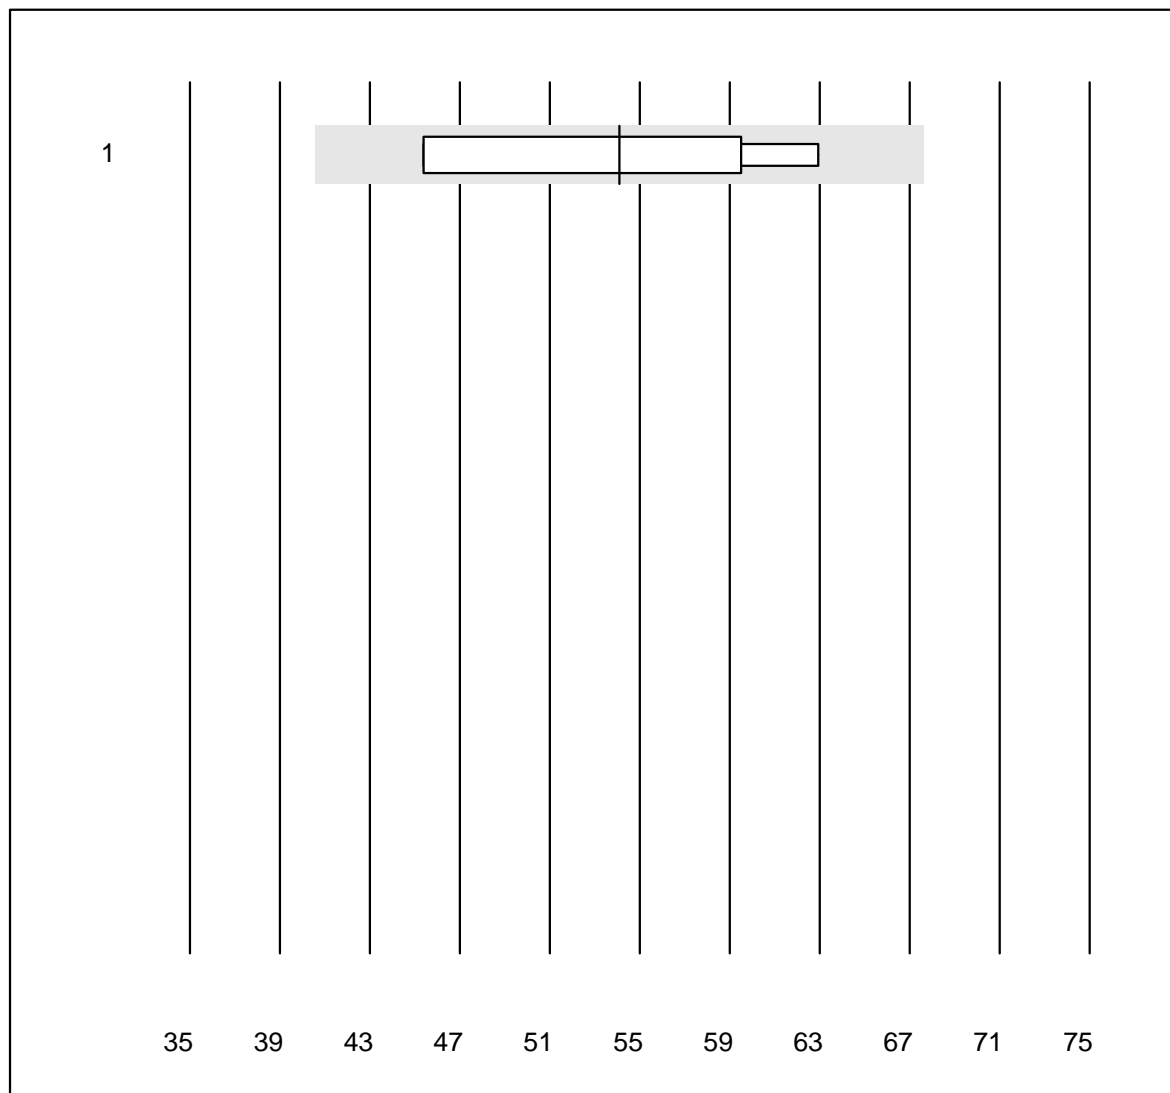

Tolérance MQ : 25 %

Thyreoglobuline (µg/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	54.1	15.5	e*

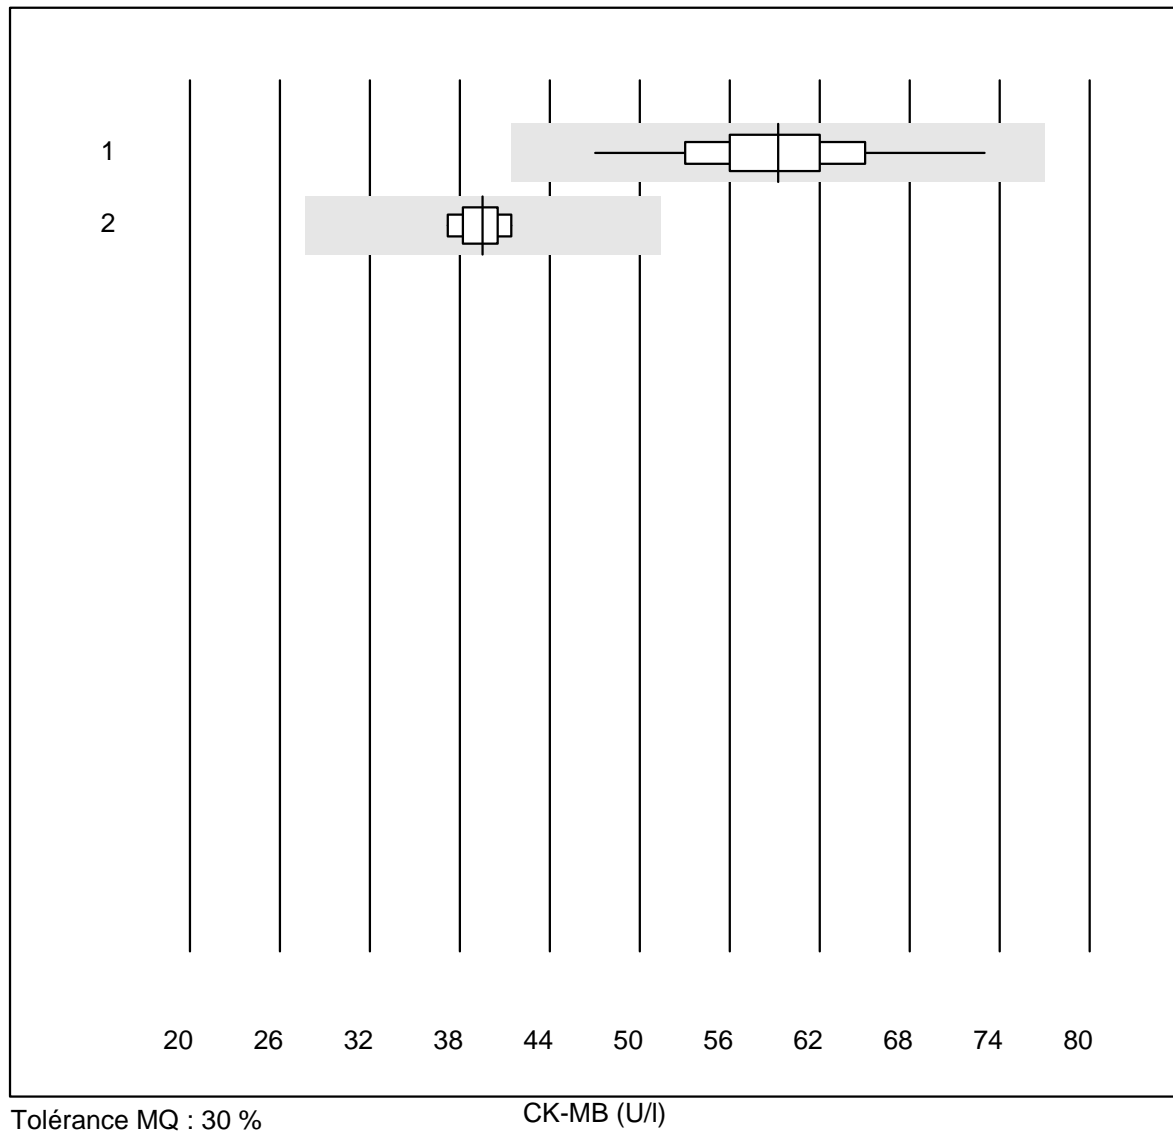
CK-MB

Tolérance MQ : 30 %

CK-MB (U/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Fuji Dri-Chem	31	93.5	0.0	6.5	59.2	8.6	e
2 Cobas/Roche	6	100.0	0.0	0.0	39.5	4.0	e

BNP

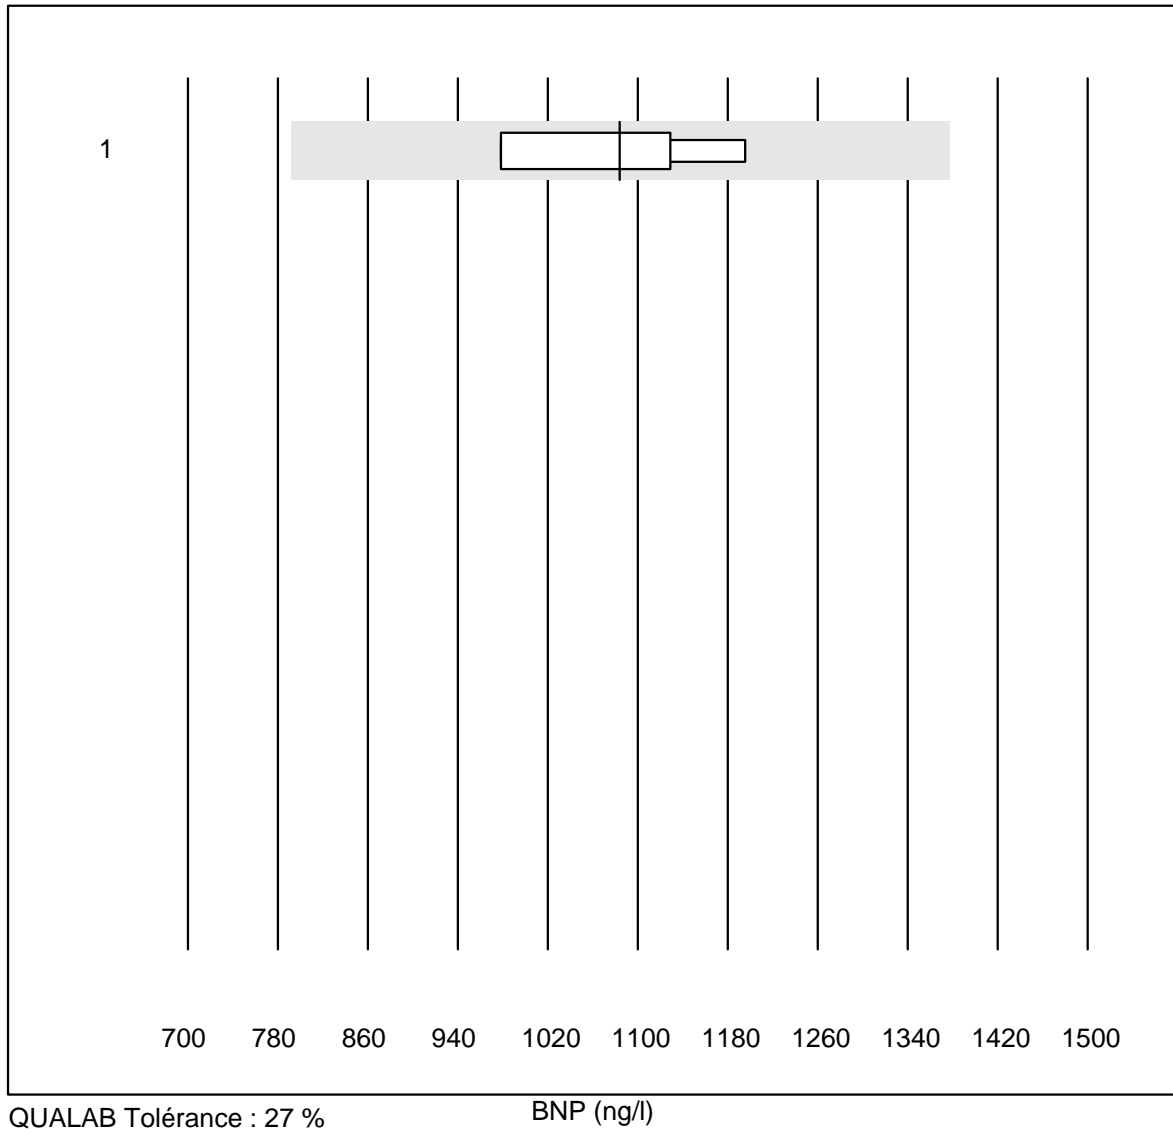

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Architect	4	100.0	0.0	0.0	1084.2	8.8	e*

Cholestérol PTS

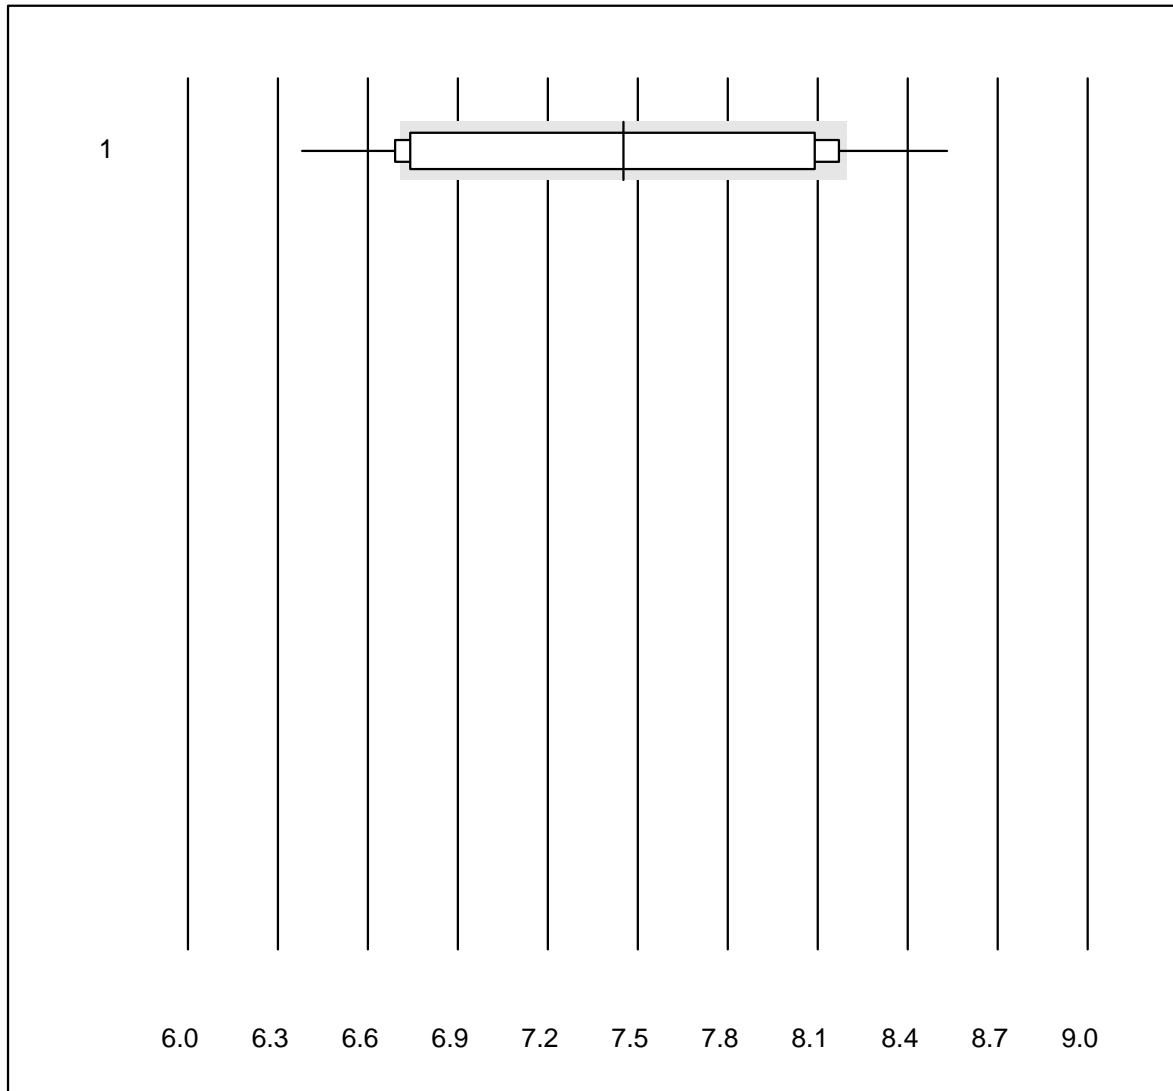


QUALAB Tolérance : 10 %

Cholestérol PTS (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 CardioChek	15	60.0	20.0	20.0	7.45	9.2	e*

Cholestérol HDL PTS

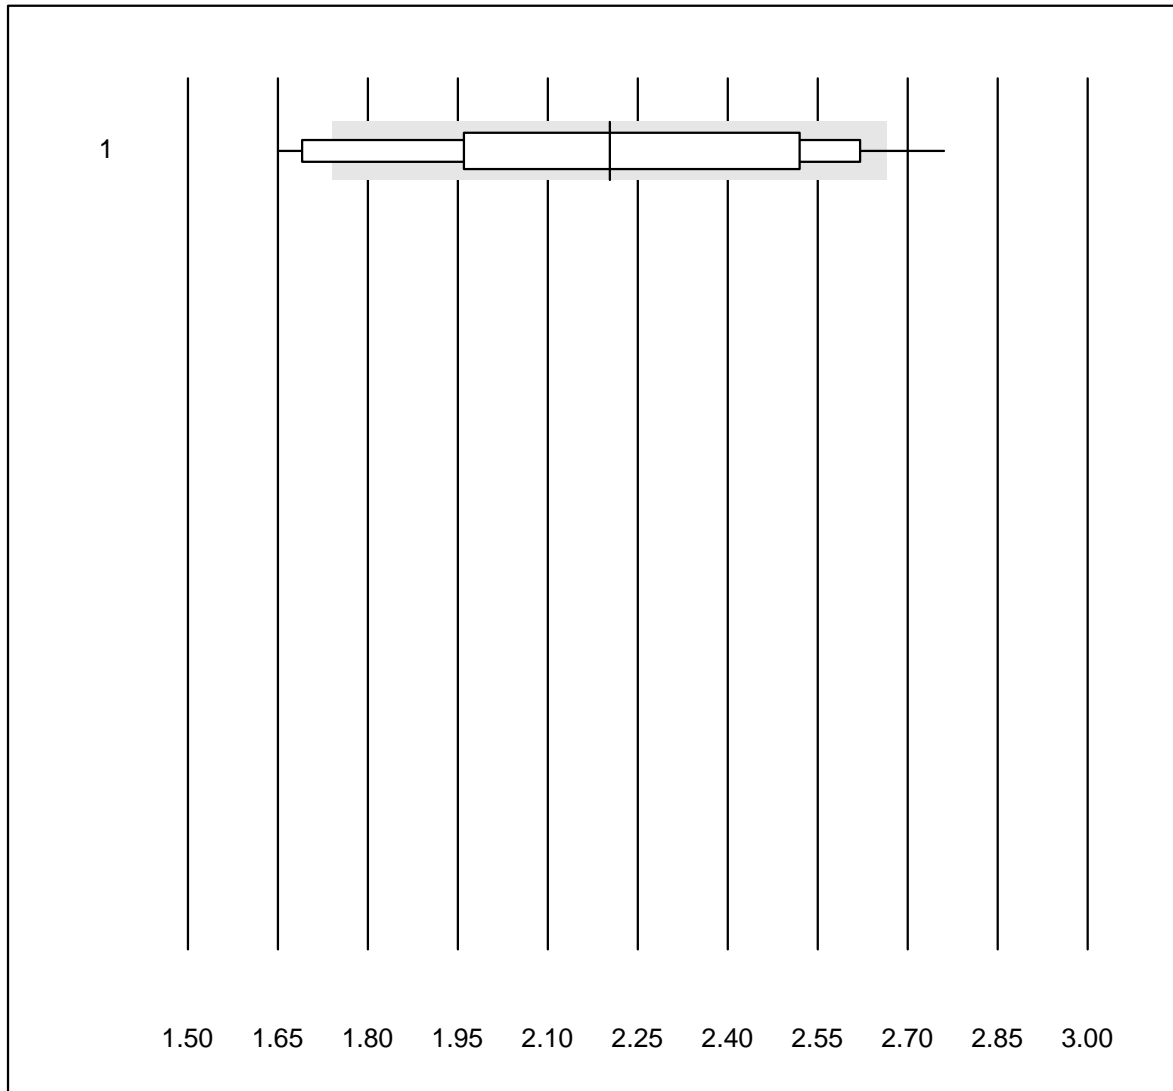


QUALAB Tolérance : 21 %

Cholestérol HDL PTS (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 CardioChek	15	73.3	20.0	6.7	2.20	15.5	e*

Triglycérides PTS

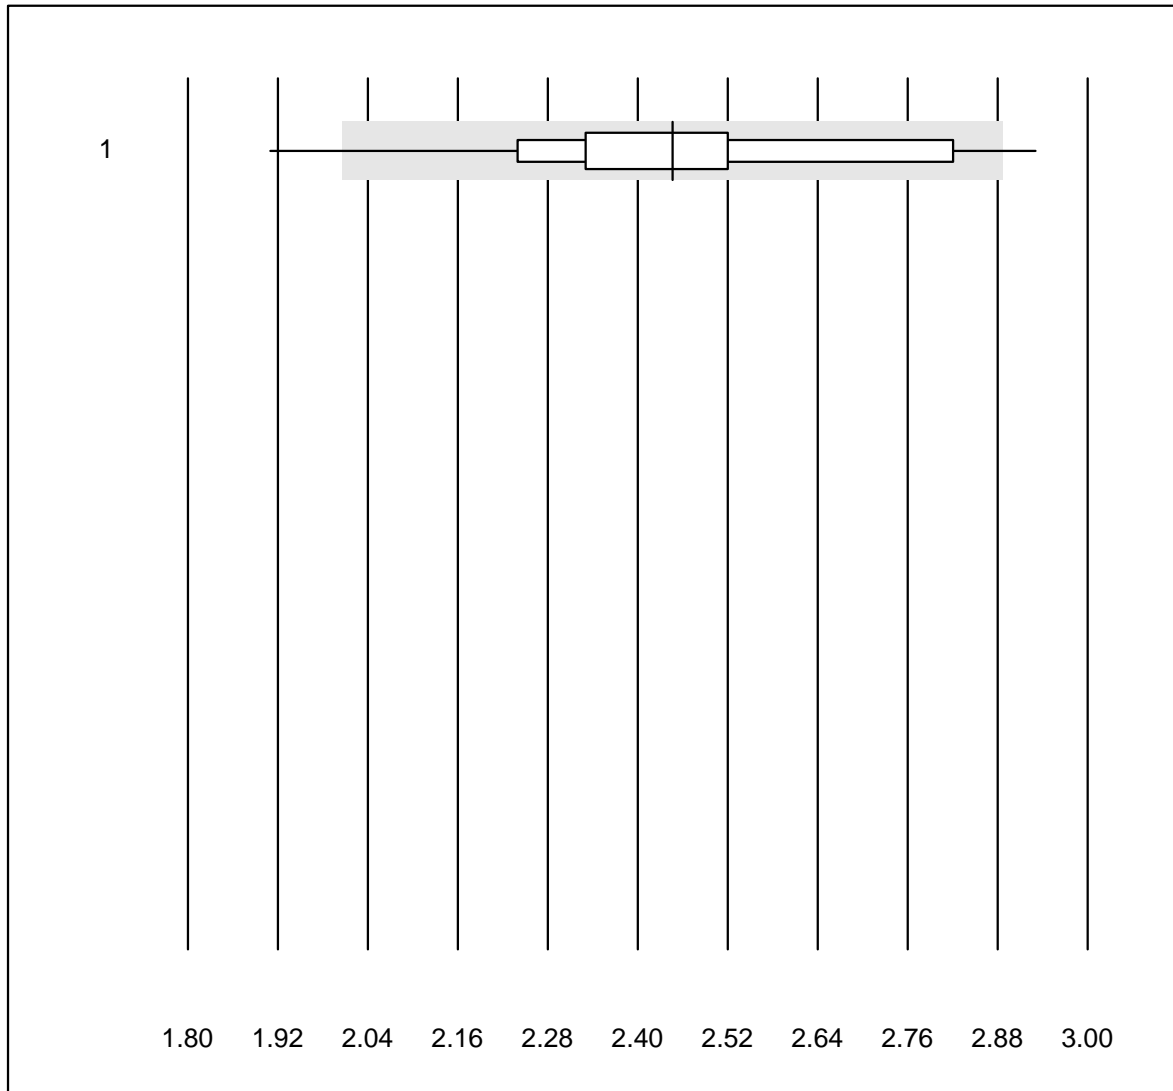


QUALAB Tolérance : 18 %

Triglycérides PTS (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 CardioChek	15	86.7	13.3	0.0	2.45	9.8	e*


C-Peptid

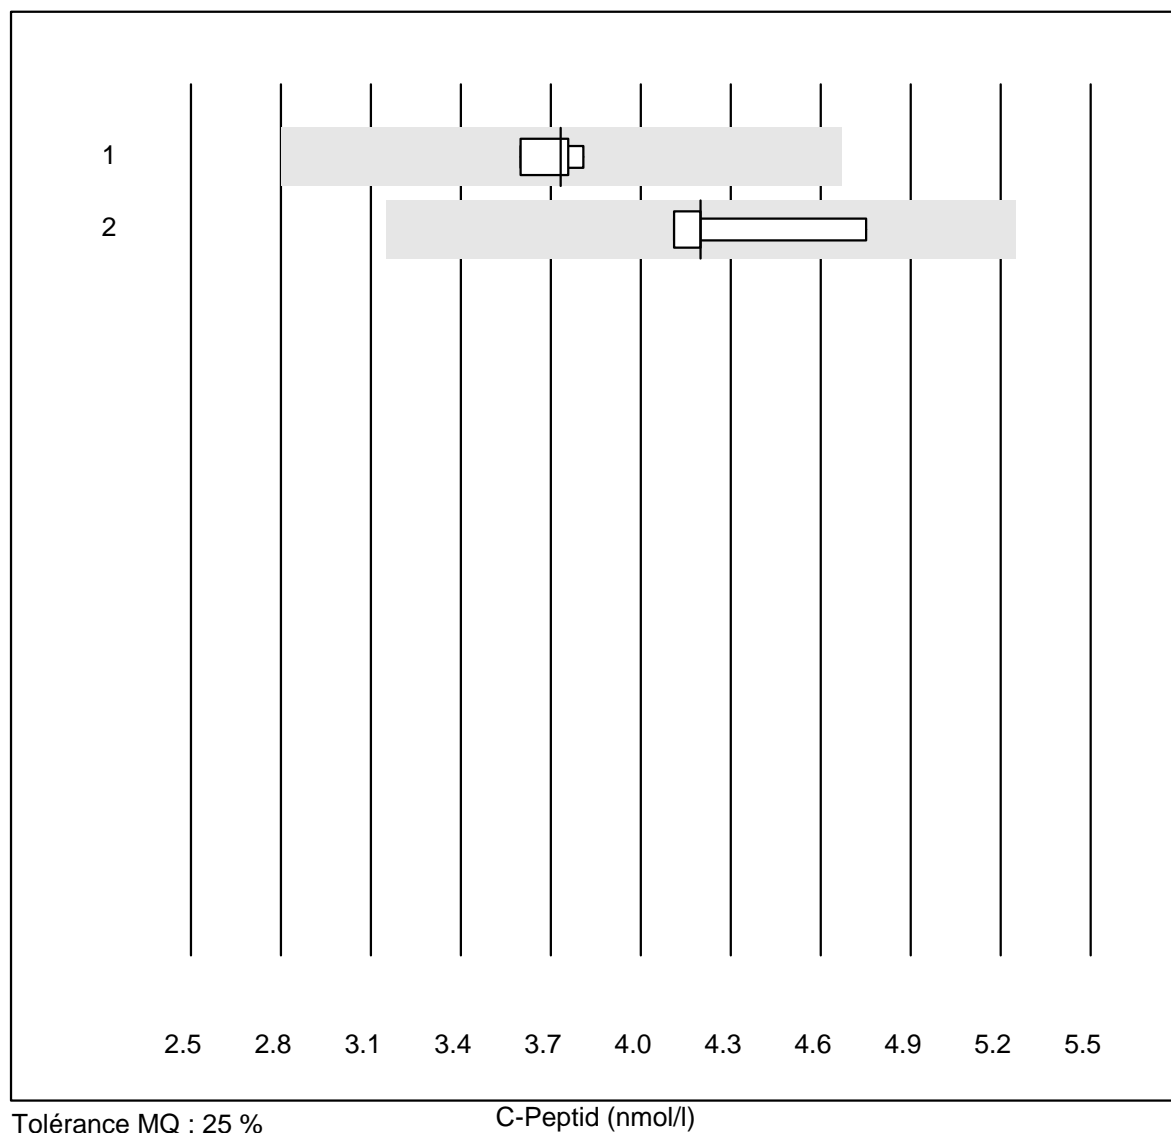

Tolérance MQ : 25 %


C-Peptid (nmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	3.73	2.4	e
2 Liaison	4	100.0	0.0	0.0	4.20	6.8	e*

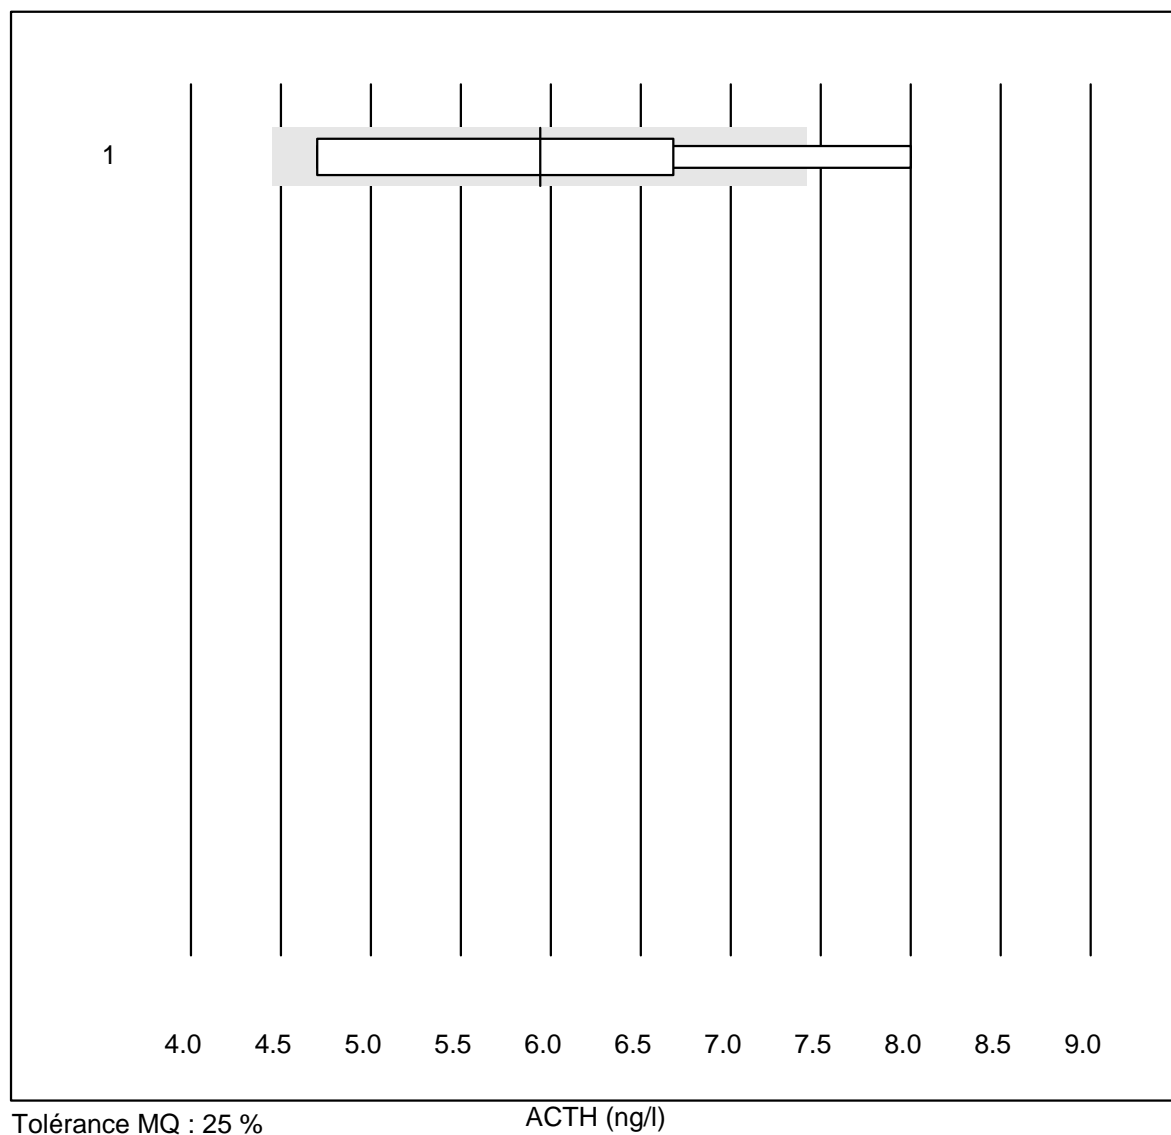ACTH


No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	4	75.0	25.0	0.0	5.94	24.3	e*

Procalcitonine

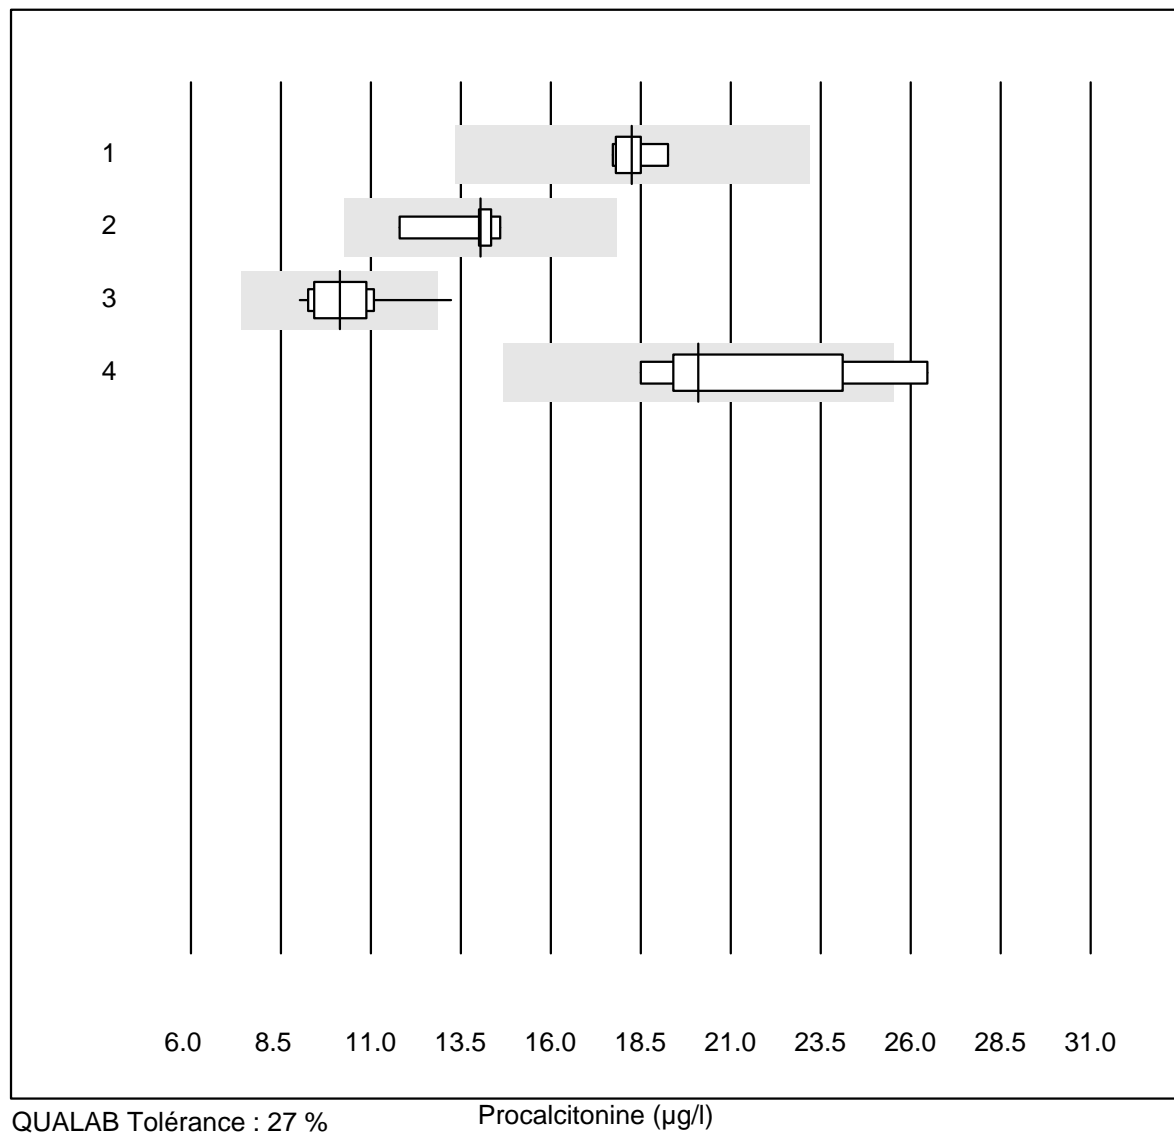

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Architect	6	100.0	0.0	0.0	18.26	3.1	e
2 Cobas	9	100.0	0.0	0.0	14.05	6.1	e
3 VIDAS	12	83.4	8.3	8.3	10.14	11.9	e*
4 Liaison	6	83.3	16.7	0.0	20.10	14.6	e*

EPO

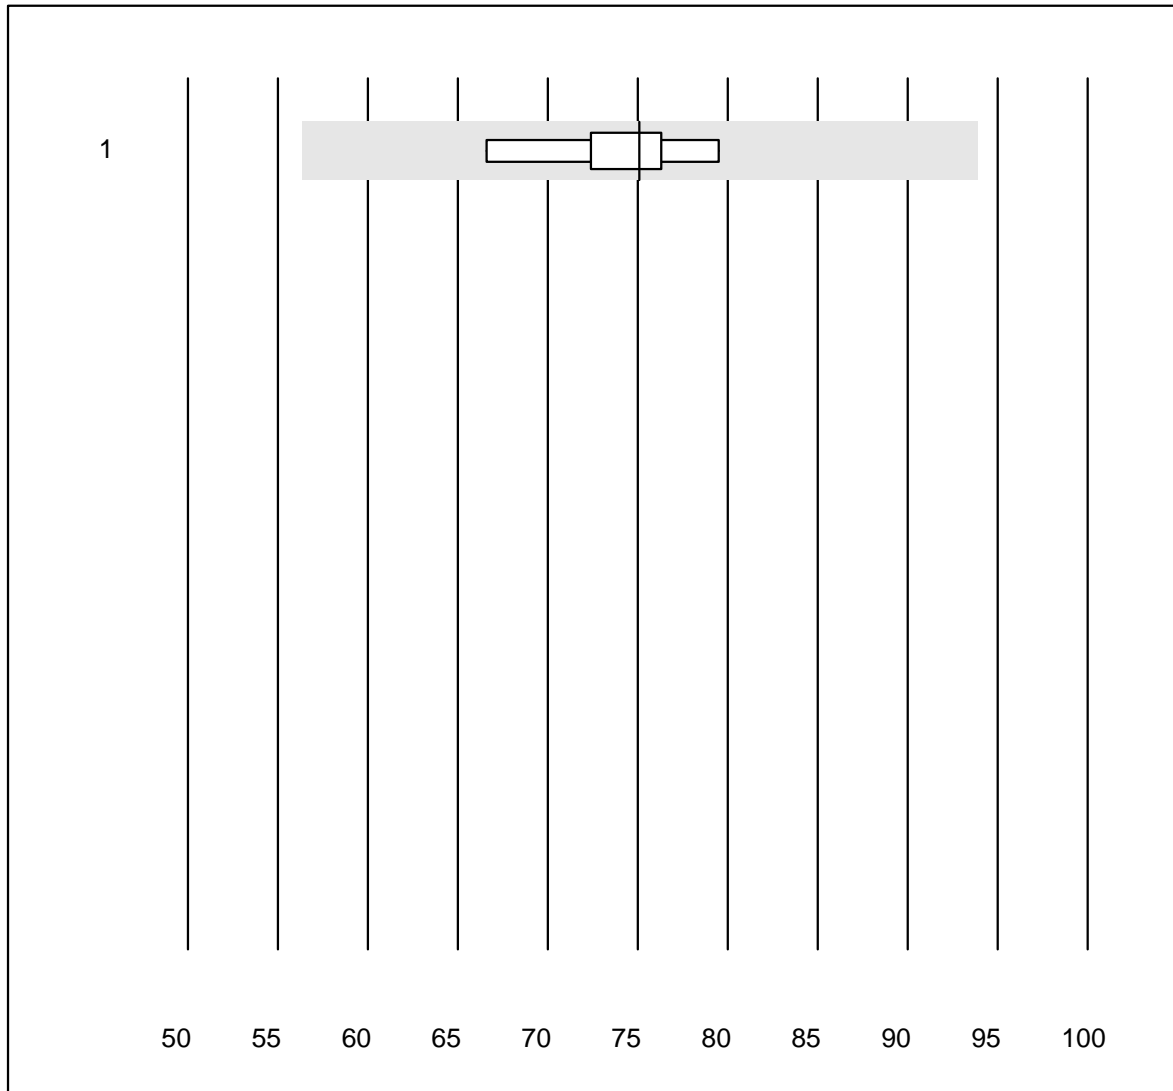


Tolérance MQ : 25 %

EPO (U/l)


No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Immulite	5	100.0	0.0	0.0	75.1	6.6	e

Parathormone

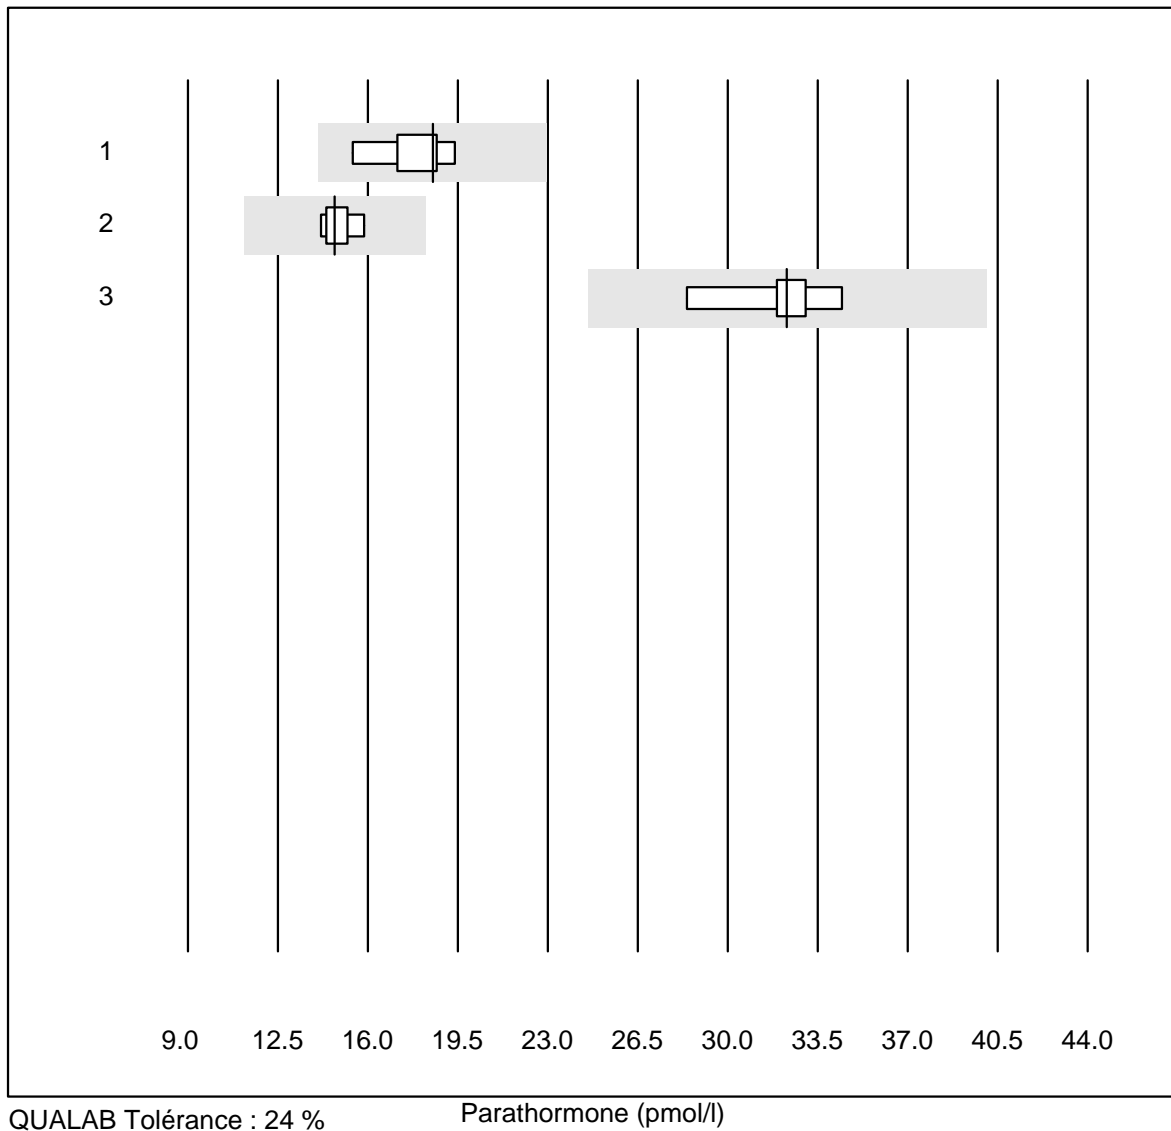

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas PTH STAT	8	100.0	0.0	0.0	18.5	7.1	e
2 Cobas	9	100.0	0.0	0.0	14.7	4.0	e
3 Architect	5	100.0	0.0	0.0	32.3	7.0	e*

Osmolalité

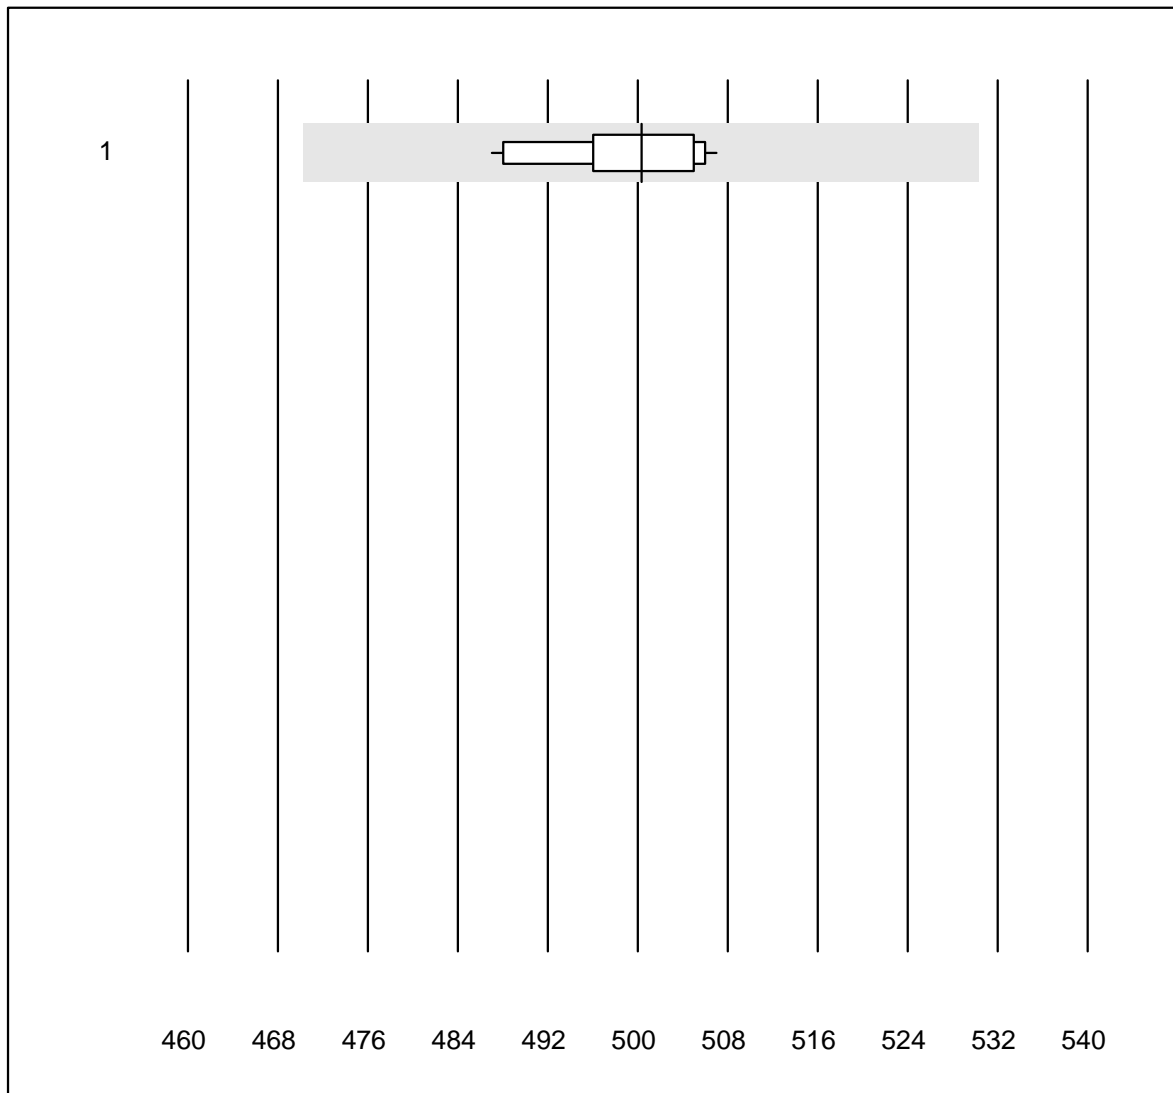


QUALAB Tolérance : 6 %

Osmolalité (mosm/kg)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cryoscopie	16	100.0	0.0	0.0	500	1.2	e

Kalium-K22

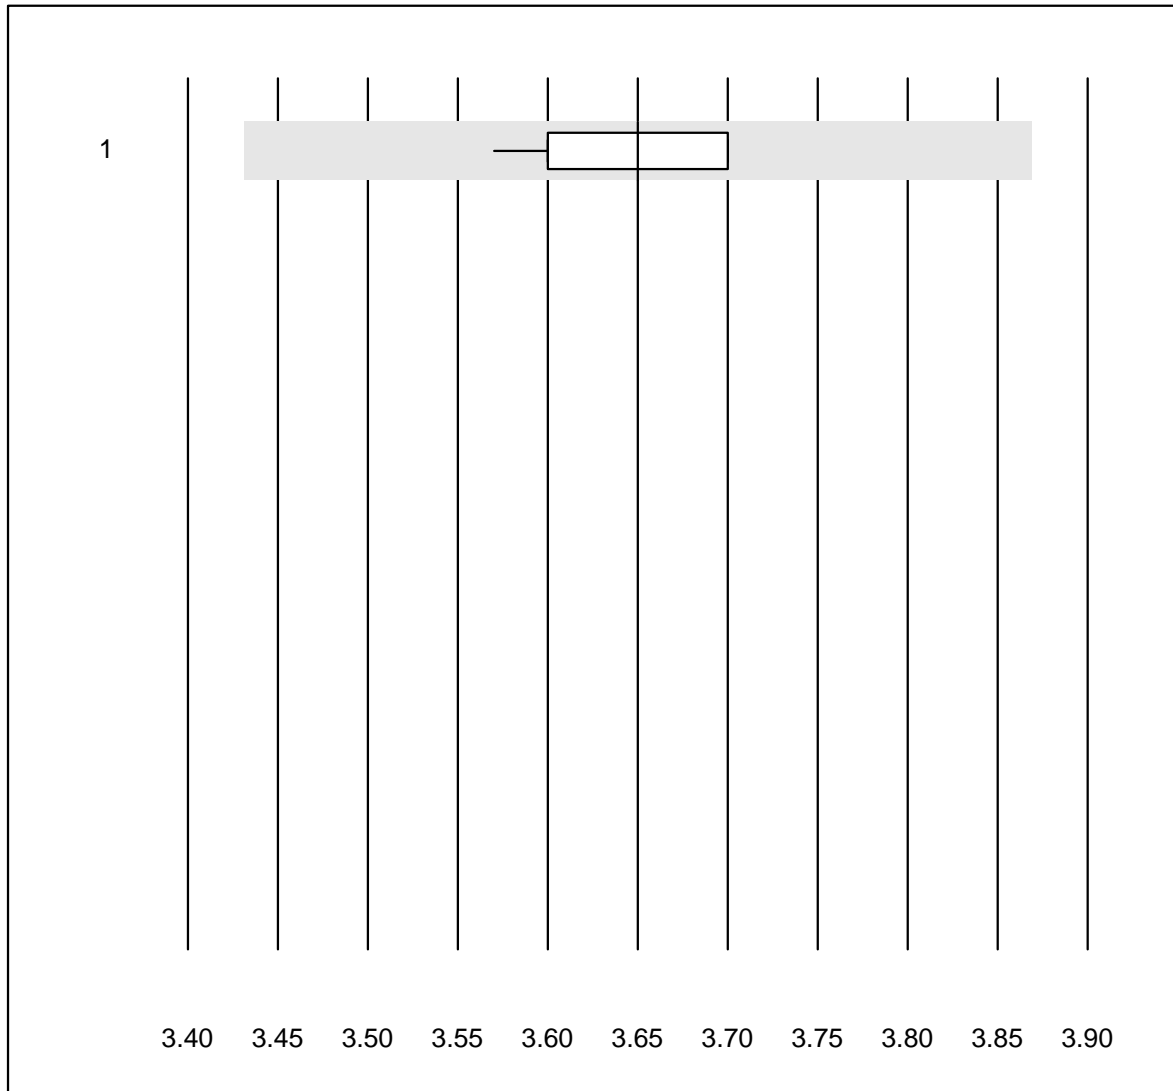


QUALAB Tolérance : 6 %

Kalium-K22 (mmol/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 ISE	11	100.0	0.0	0.0	3.7	1.4	e

Natrium-K22

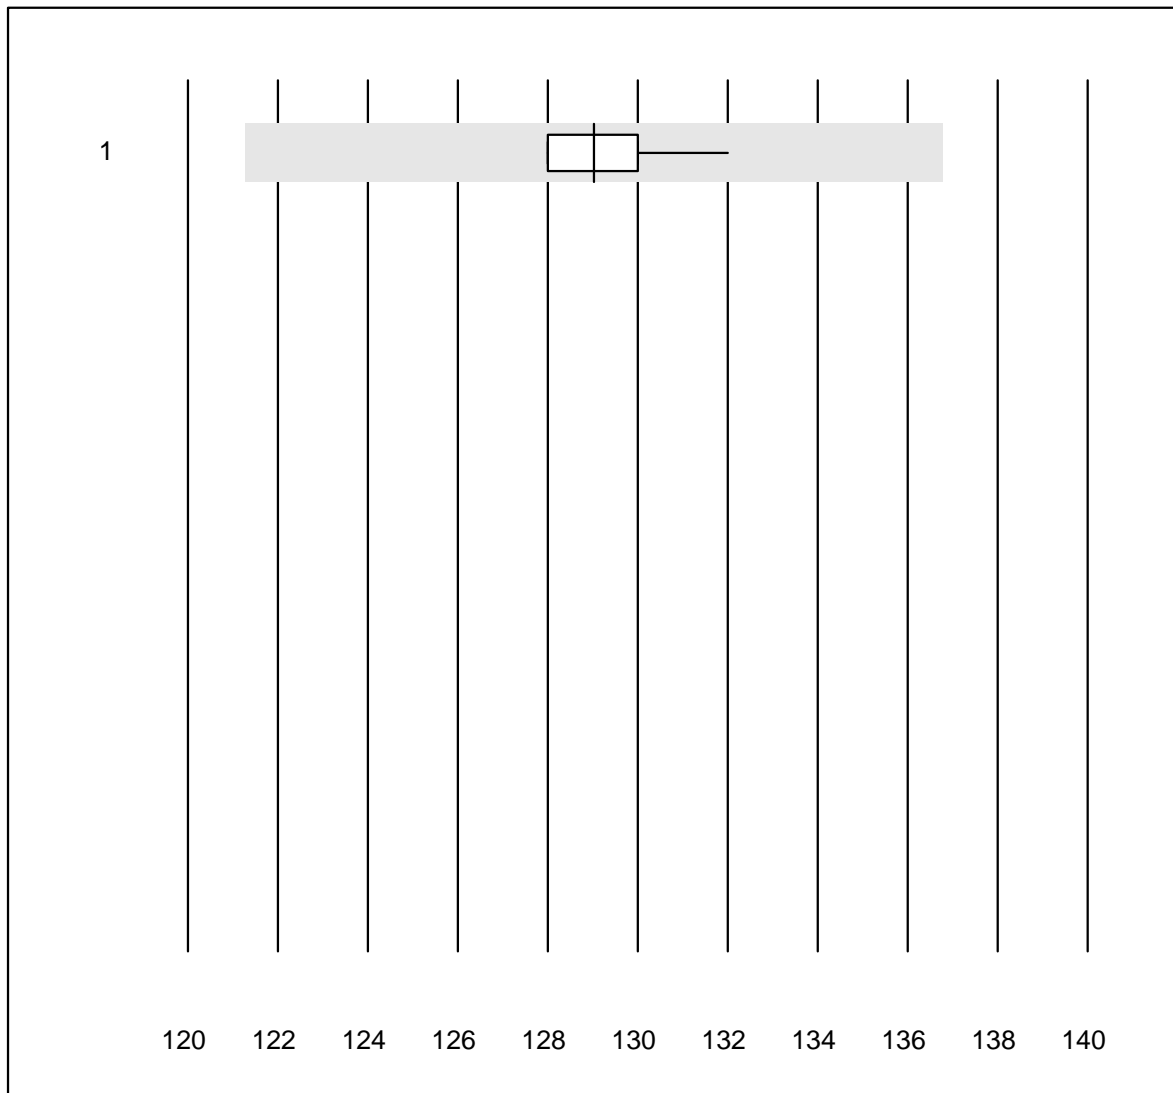


QUALAB Tolérance : 6 %

Natrium-K22 (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 ISE	11	100.0	0.0	0.0	129	1.0	e

Glukose-K22

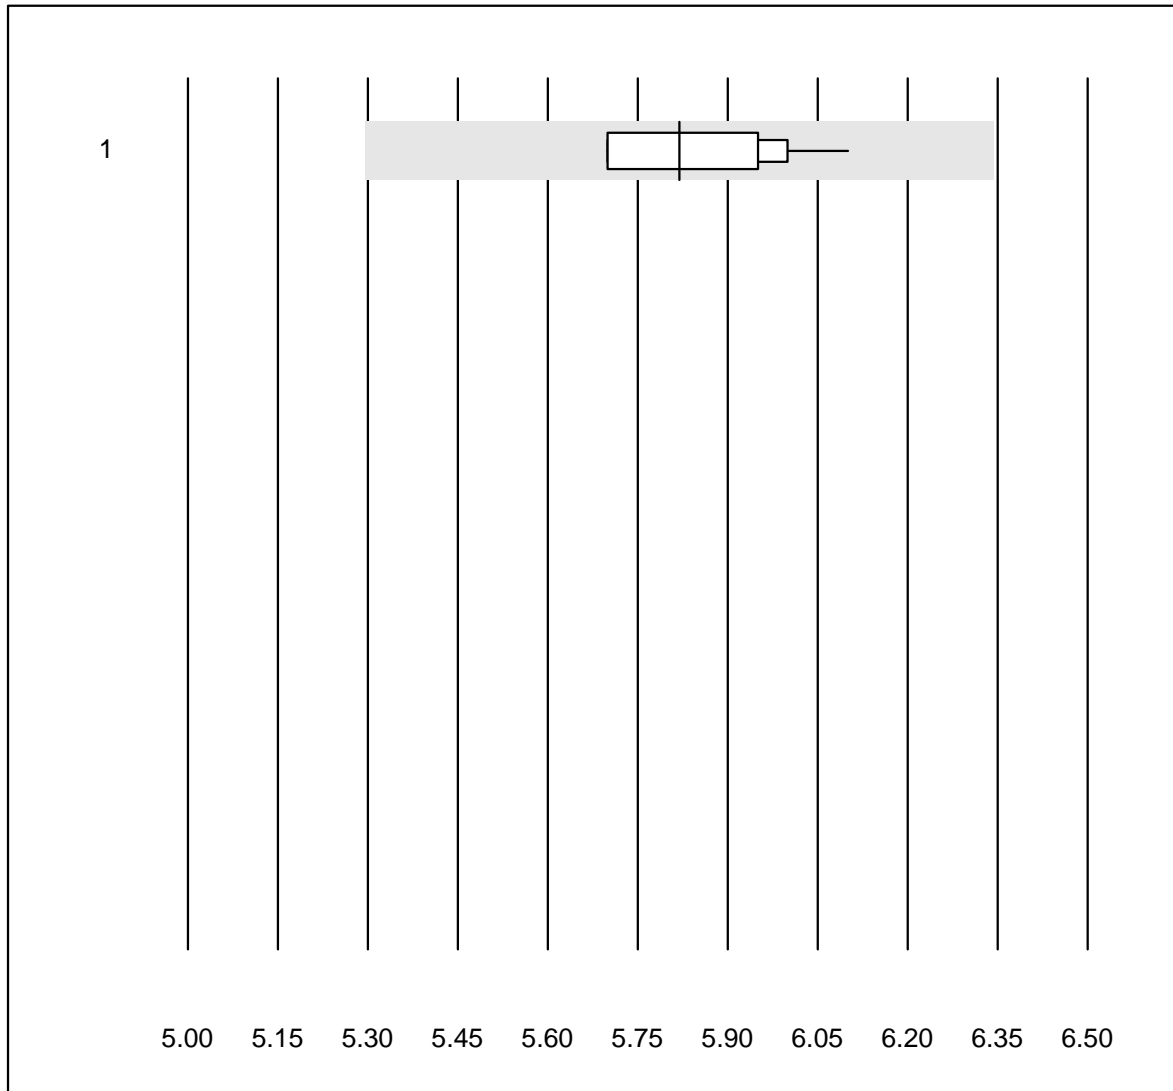


QUALAB Tolérance : 9 %

Glukose-K22 (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	11	100.0	0.0	0.0	5.8	2.4	e

Harnstoff-K22

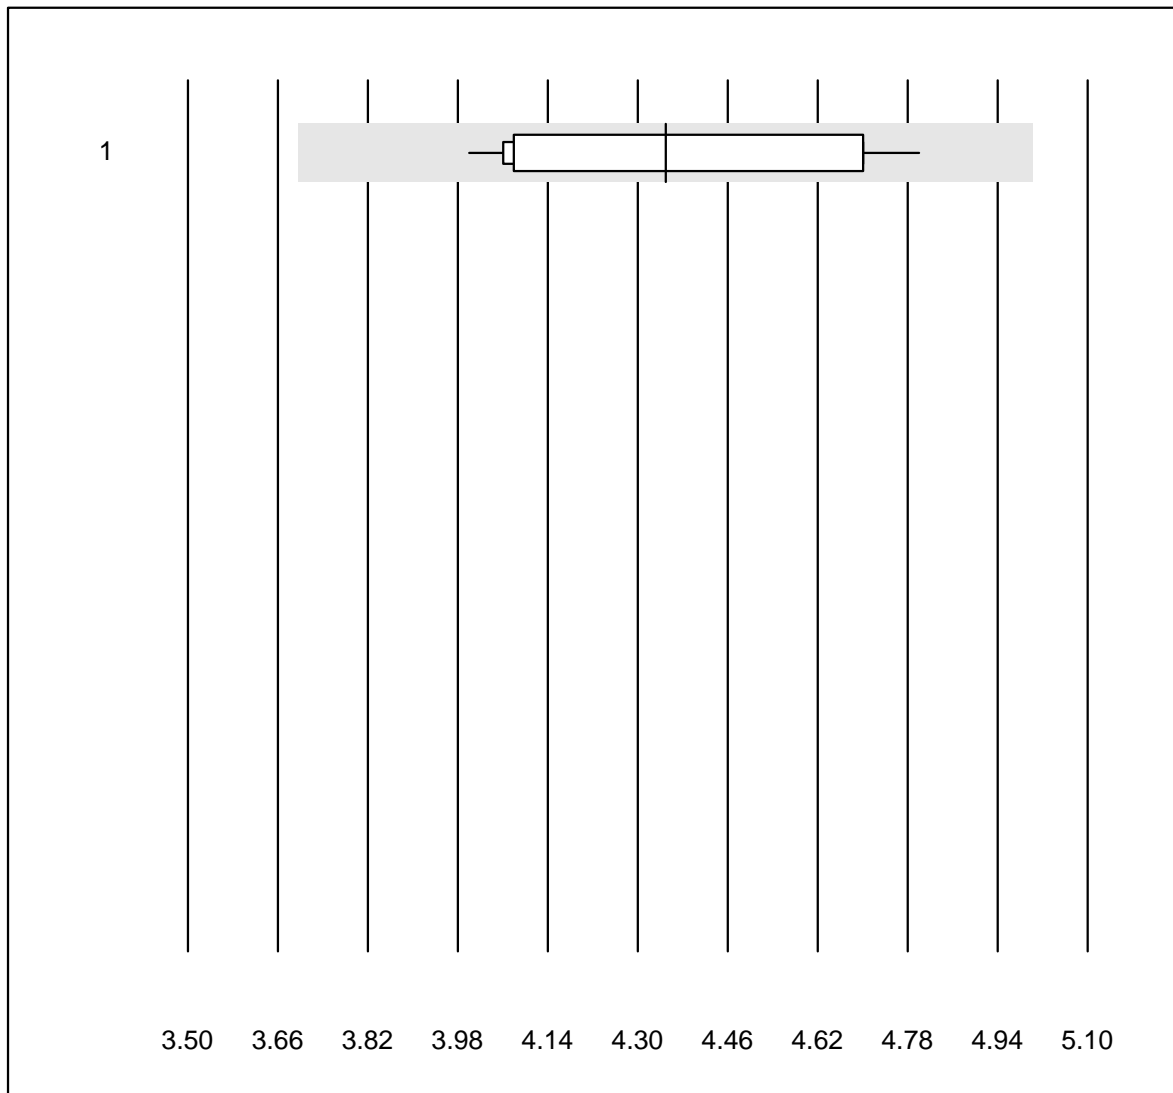


QUALAB Tolérance : 15 %

Harnstoff-K22 (mmol/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	11	100.0	0.0	0.0	4.3	6.3	e*

Osmotische Lücke

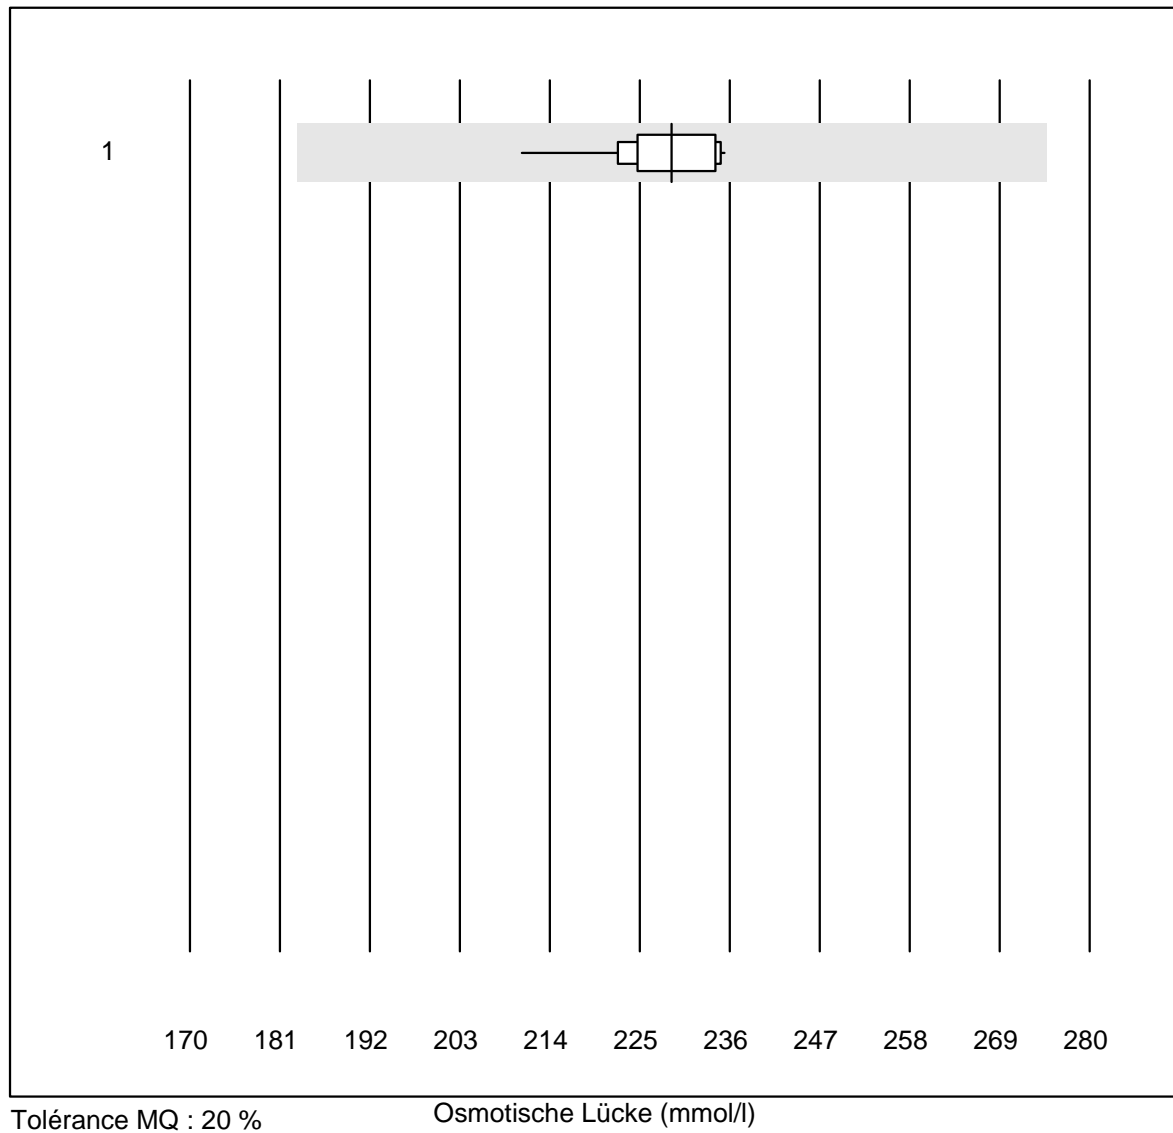

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Formel 1 (2Na+K+Glu+	11	100.0	0.0	0.0	228.9	3.2	e

Digoxin

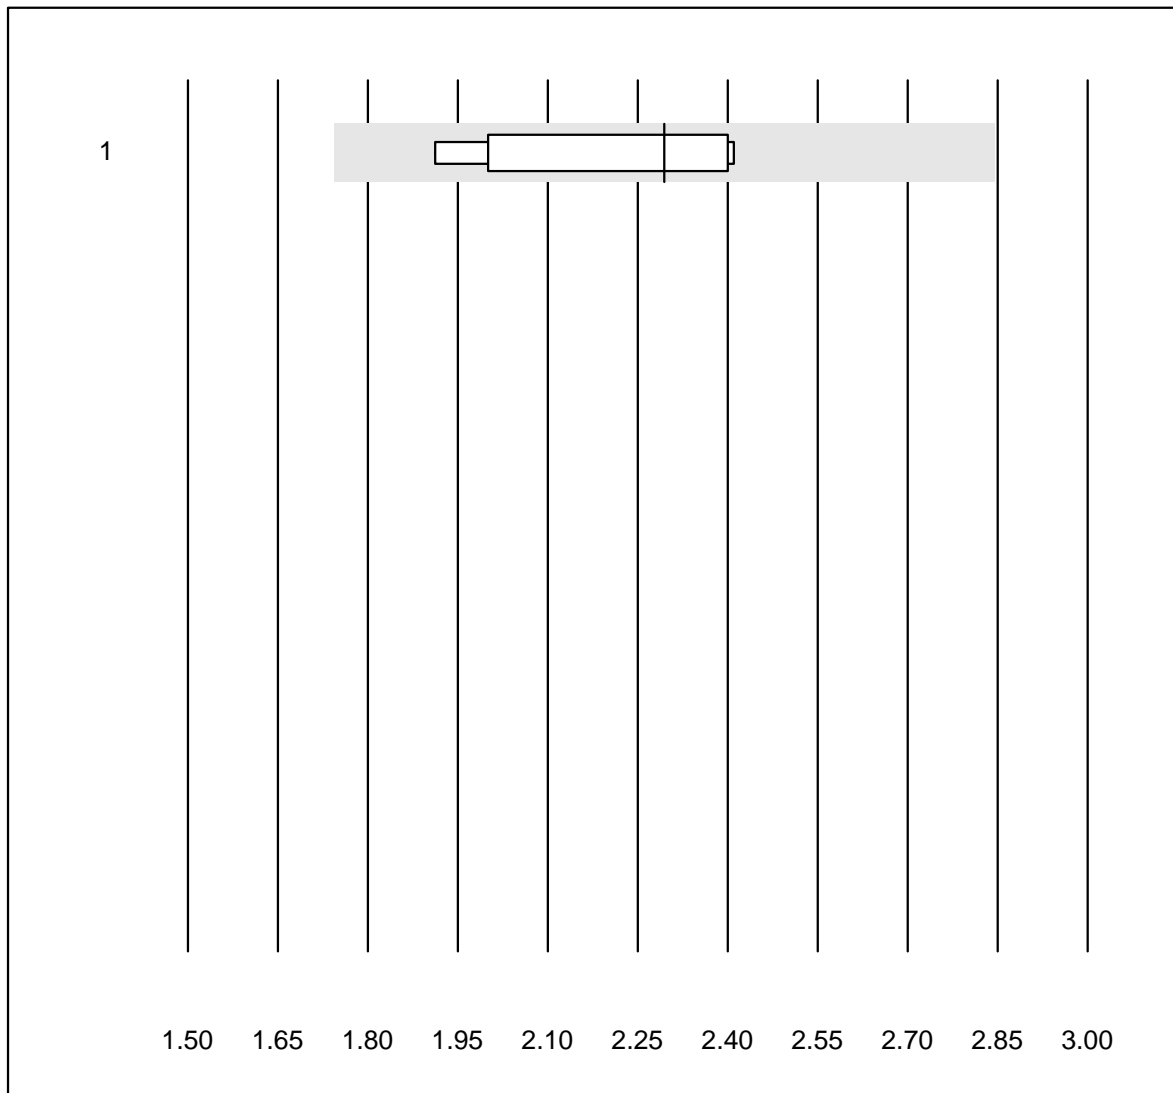


QUALAB Tolérance : 24 %

Digoxin (nmol/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Autres méthodes	6	100.0	0.0	0.0	2.29	9.5	e*

Paracetamol

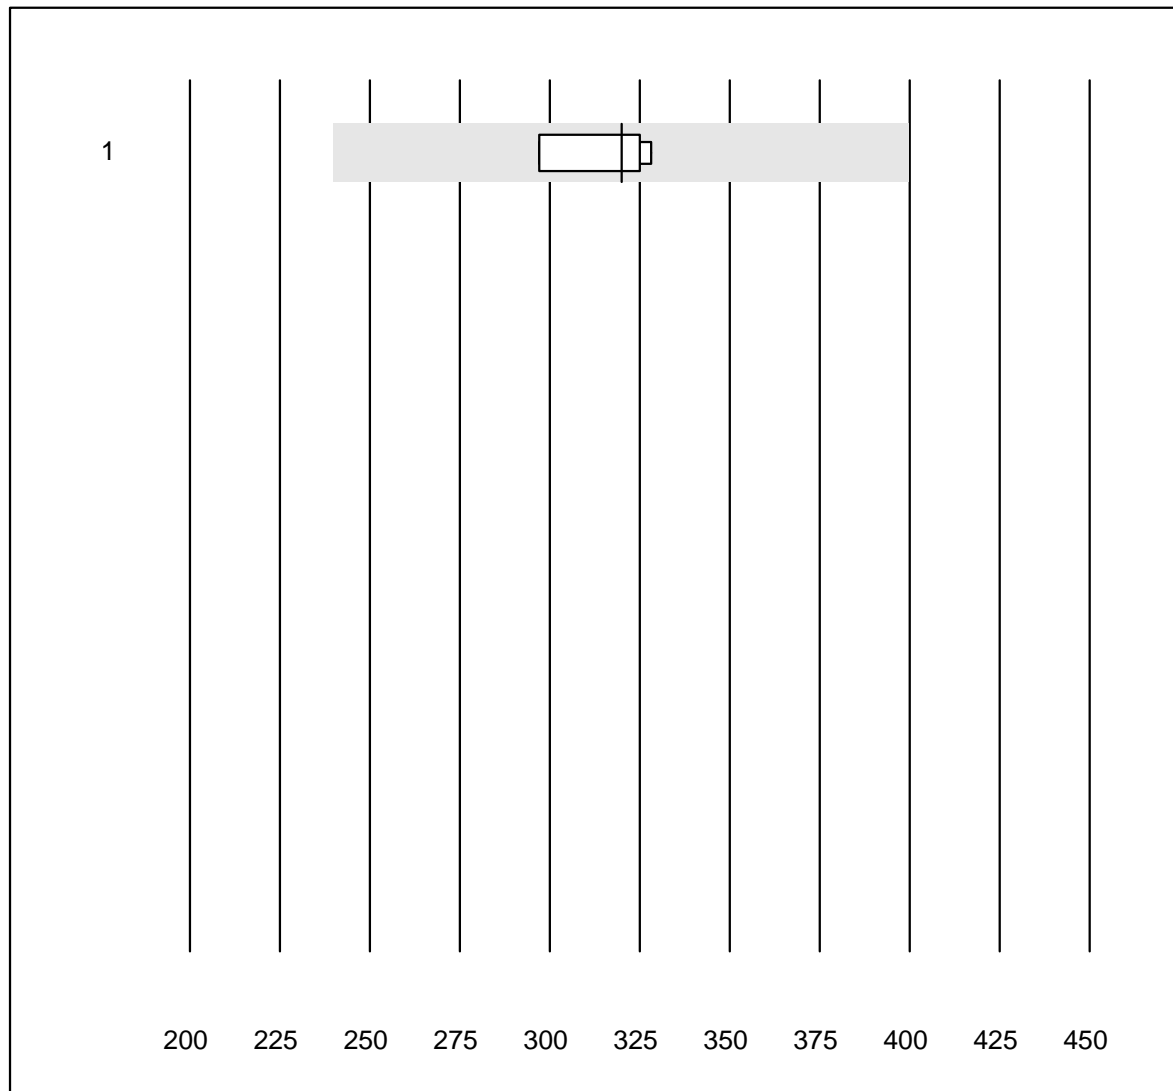


Tolérance MQ : 25 %

Paracetamol ($\mu\text{mol/l}$)


No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	319.9	4.4	e

Valproat

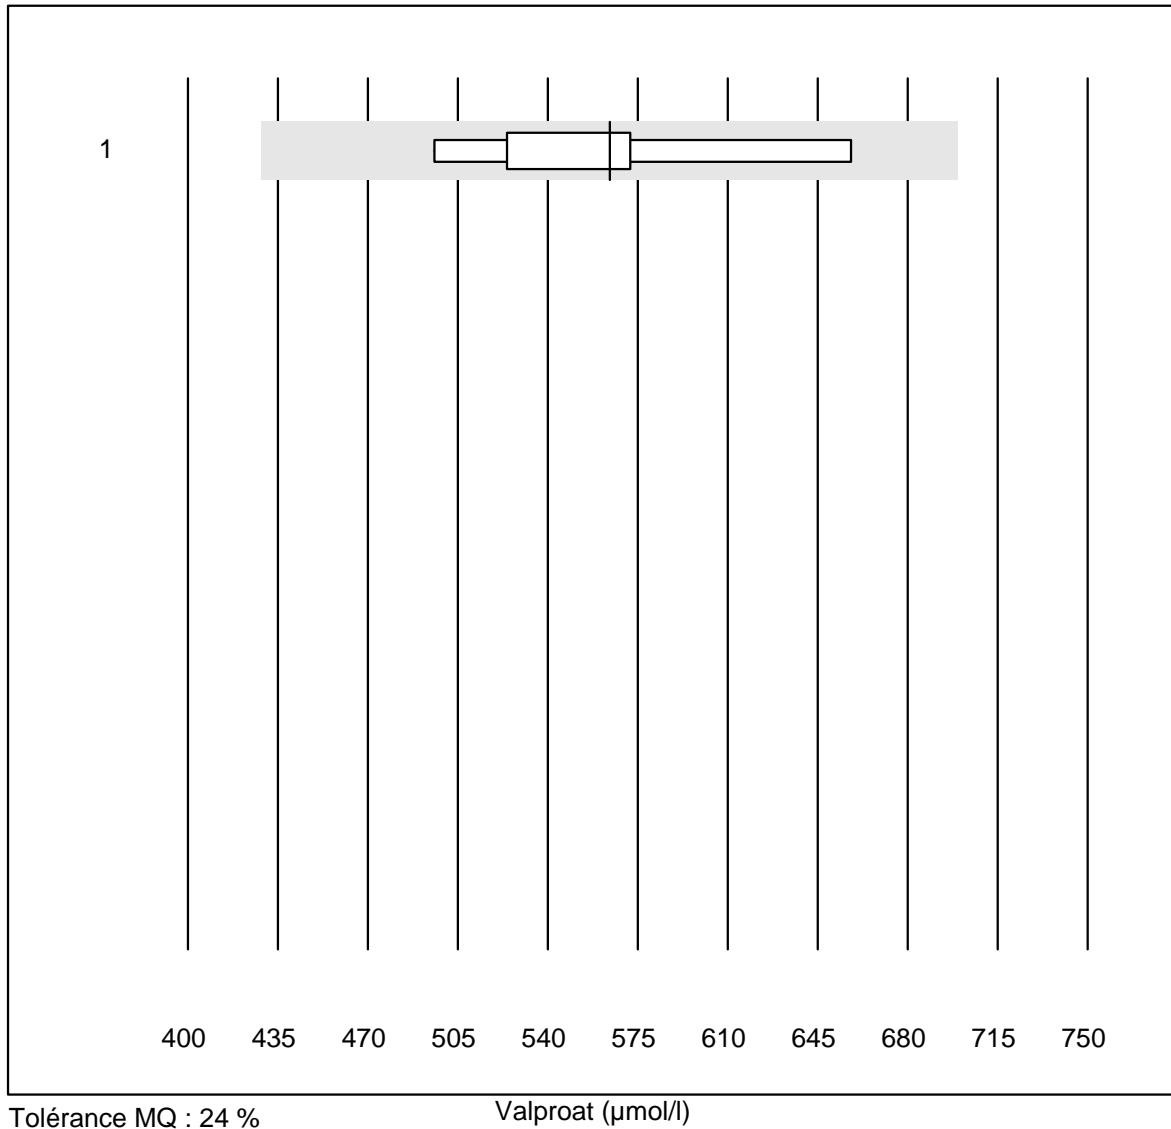

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	564.0	9.8	e*

Cystatin C

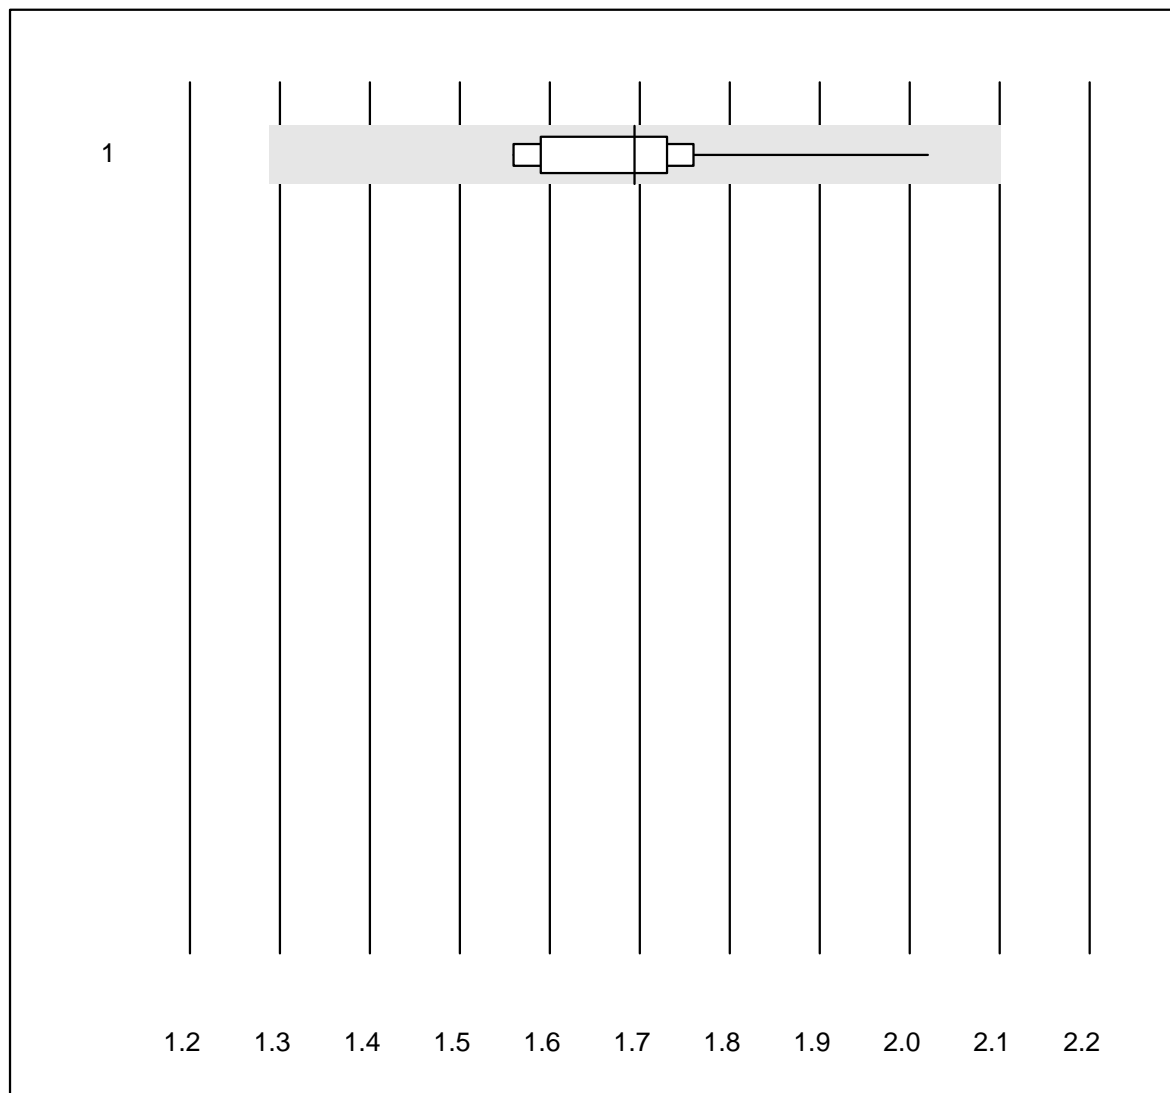


Tolérance MQ : 24 %

Cystatin C (mg/l)


No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	10	100.0	0.0	0.0	1.69	7.9	e

Éthanol

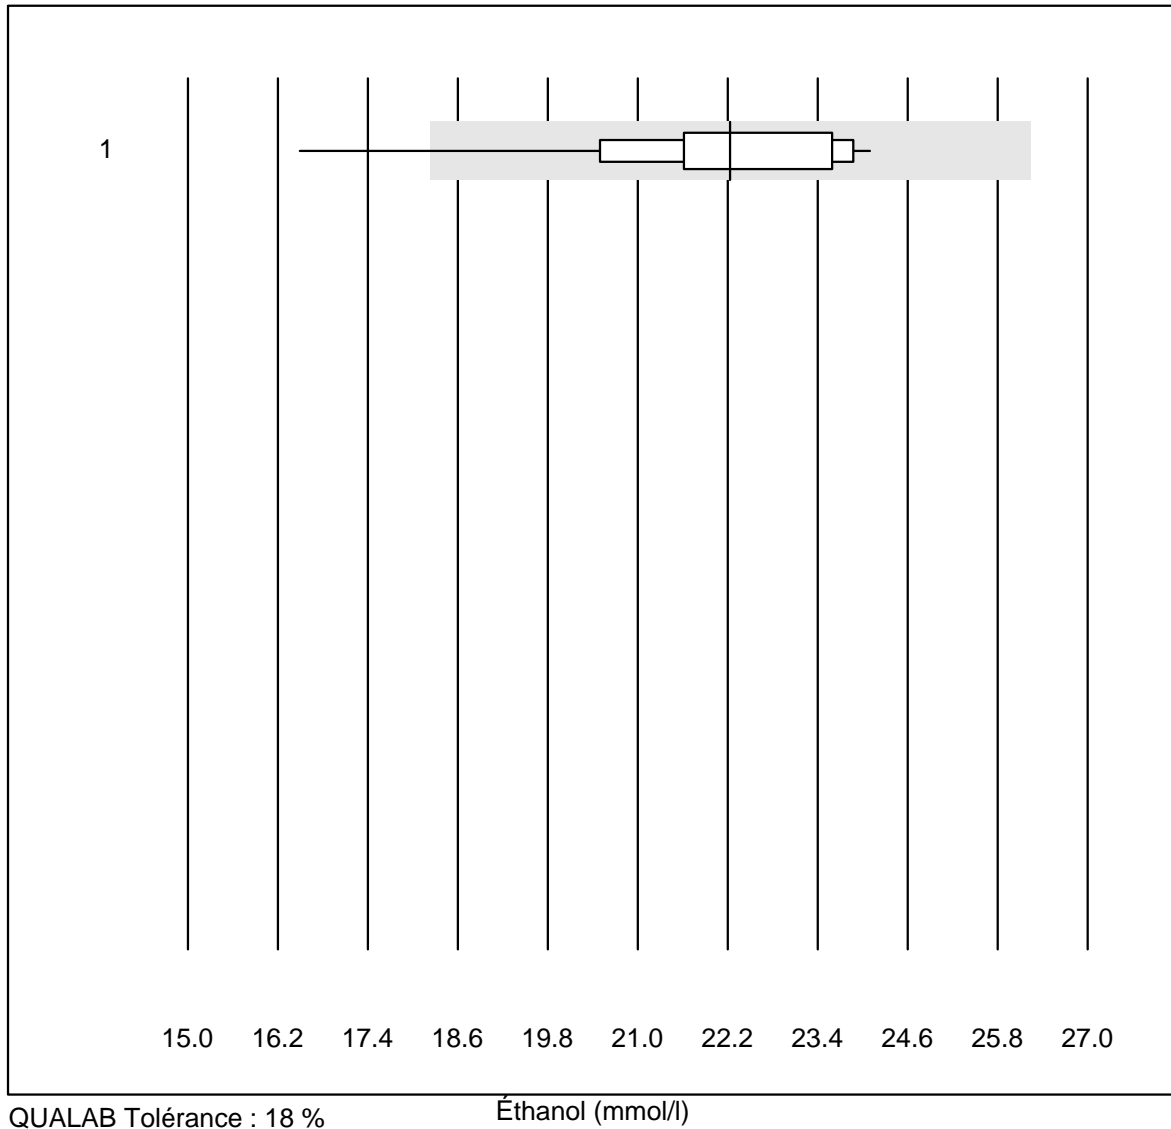

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	27	96.3	3.7	0.0	22.2	7.1	e

Calprotectine

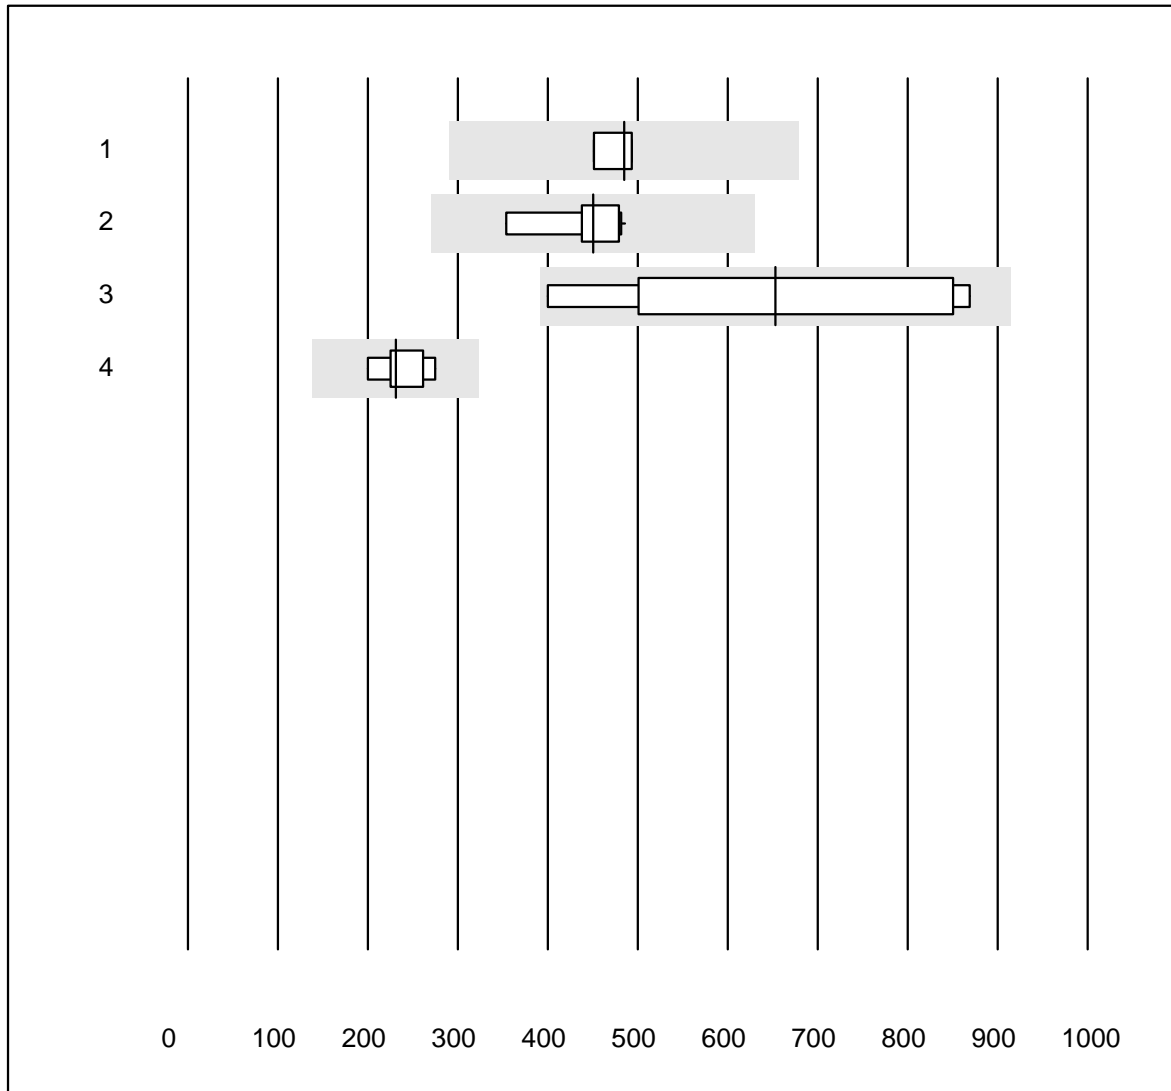


Tolérance MQ : 40 %

Calprotectine (µg/g)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Bühlmann ELISA	4	100.0	0.0	0.0	485	4.1	e
2 Bühlmann fCALturbo	12	83.3	0.0	16.7	450	9.2	e
3 Bühlmann Quantum Blu	5	100.0	0.0	0.0	653	31.8	a
4 Liaison	6	83.3	0.0	16.7	231	12.6	a

Cholestérol Af/b101

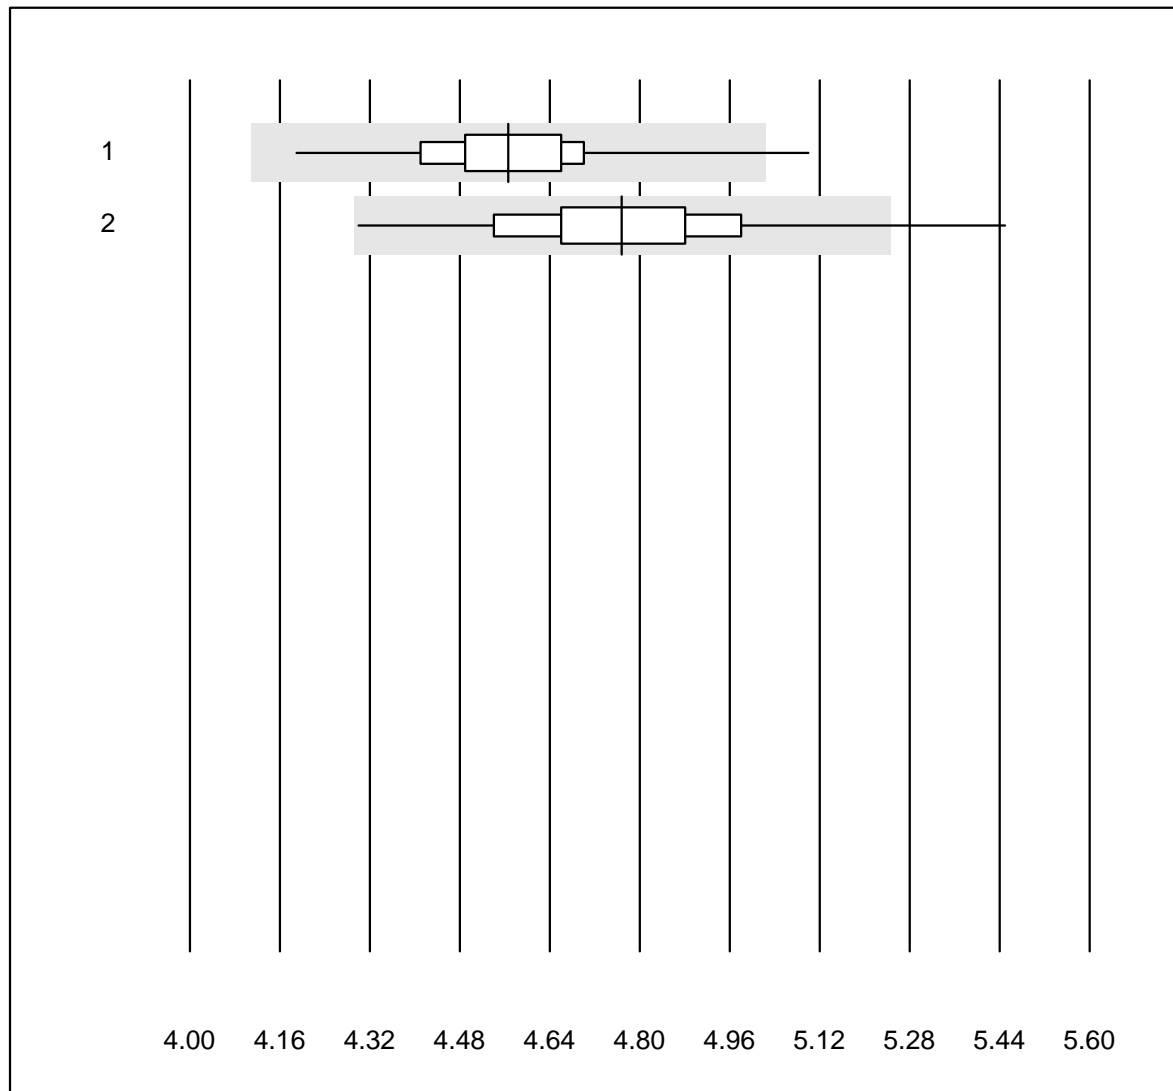


QUALAB Tolérance : 10 %

Cholestérol Af/b101 (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas b101	205	98.0	0.5	1.5	4.57	2.7	e
2 Afinion	428	98.9	0.9	0.2	4.77	3.6	e


Cholestérol HDL Af/b101

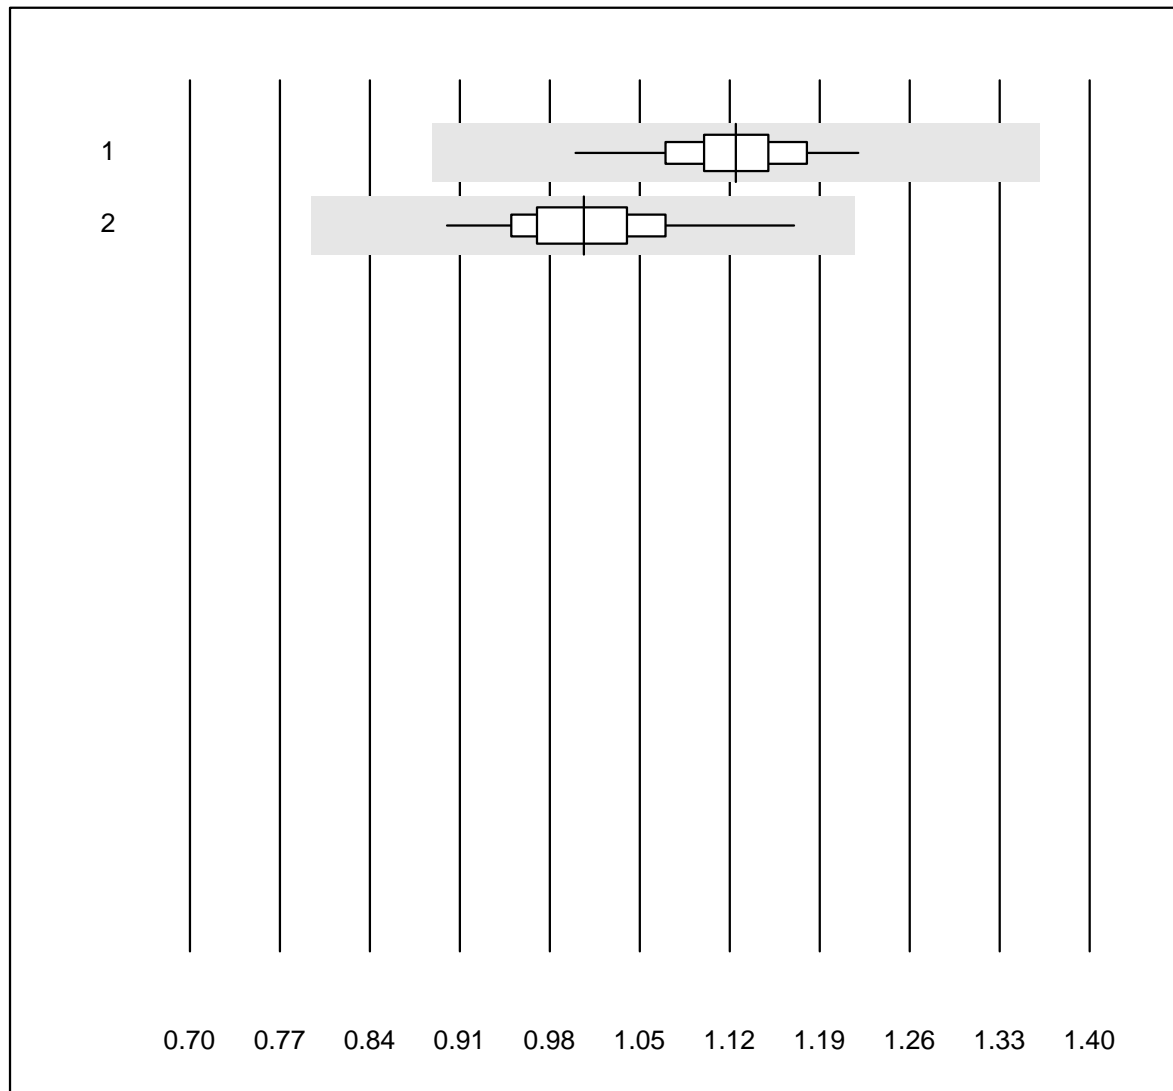

QUALAB Tolérance : 21 % Cholestérol HDL Af/b101 (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas b101	204	90.2	0.0	9.8	1.12	3.9	e
2 Afinion	424	90.3	0.0	9.7	1.01	4.7	e

Triglycerides Af/b101

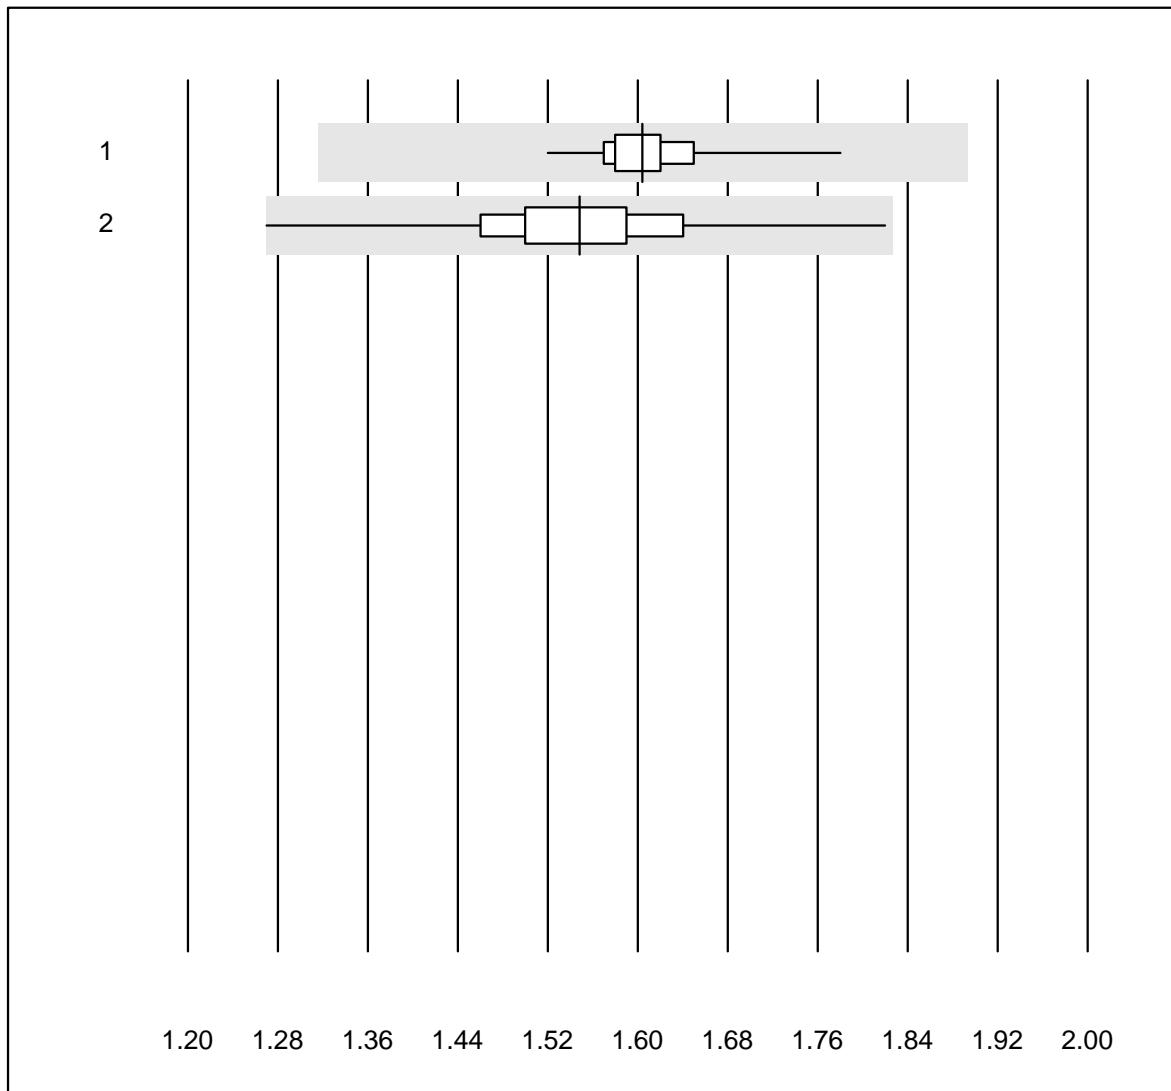


QUALAB Tolérance : 18 %

Triglycerides Af/b101 (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas b101	202	98.5	0.0	1.5	1.60	2.3	e
2 Afinion	430	99.3	0.0	0.7	1.55	4.6	e

Troponine I S

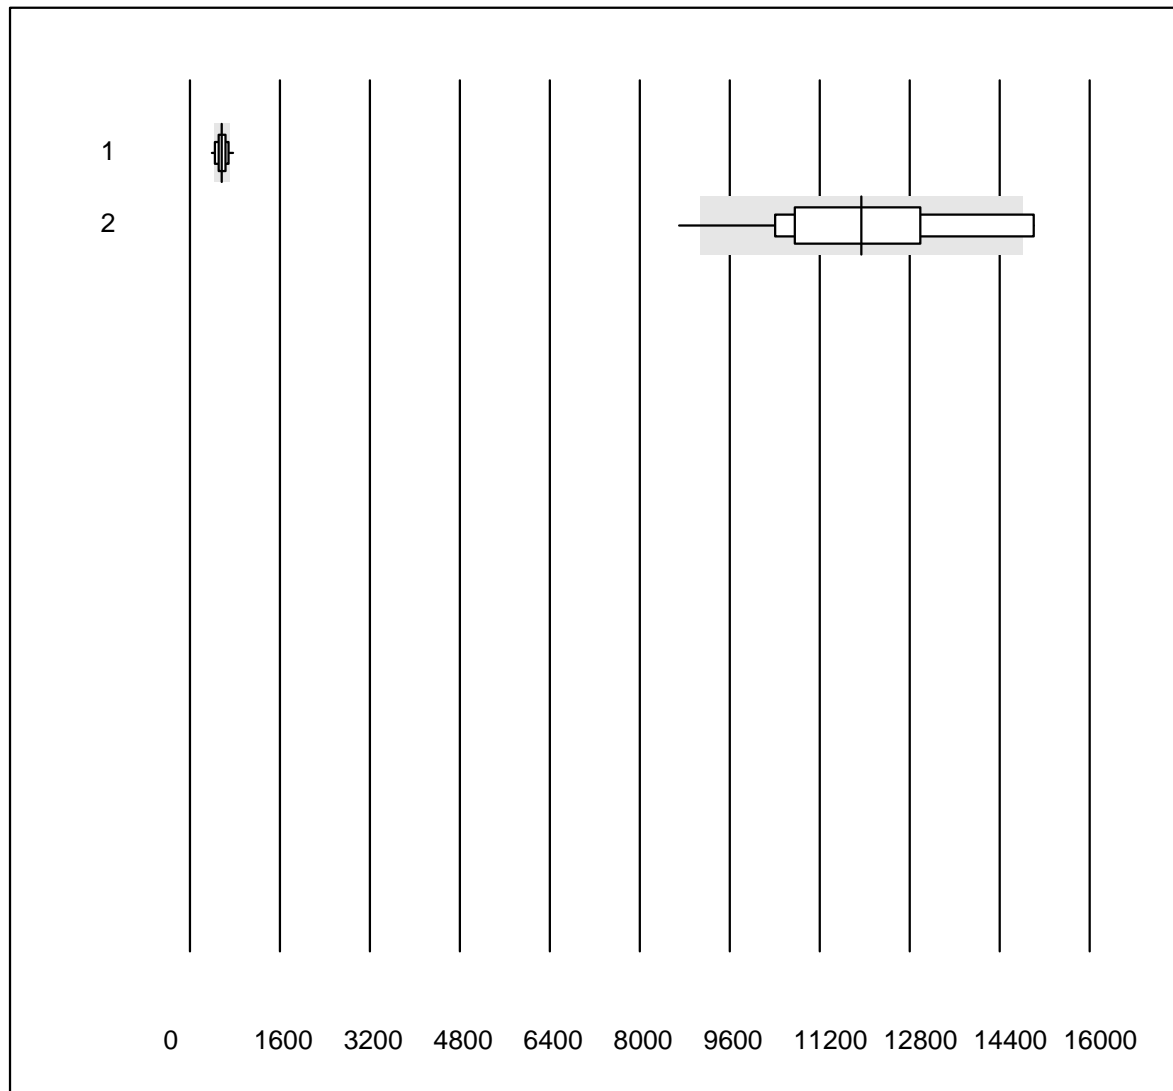


QUALAB Tolérance : 24 %

Troponine I S (ng/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Exdia TRF	38	68.4	15.8	15.8	571.22	16.3	e
2 AFIAS	179	86.6	12.3	1.1	11933.81	13.4	e

D-Dimères qn S

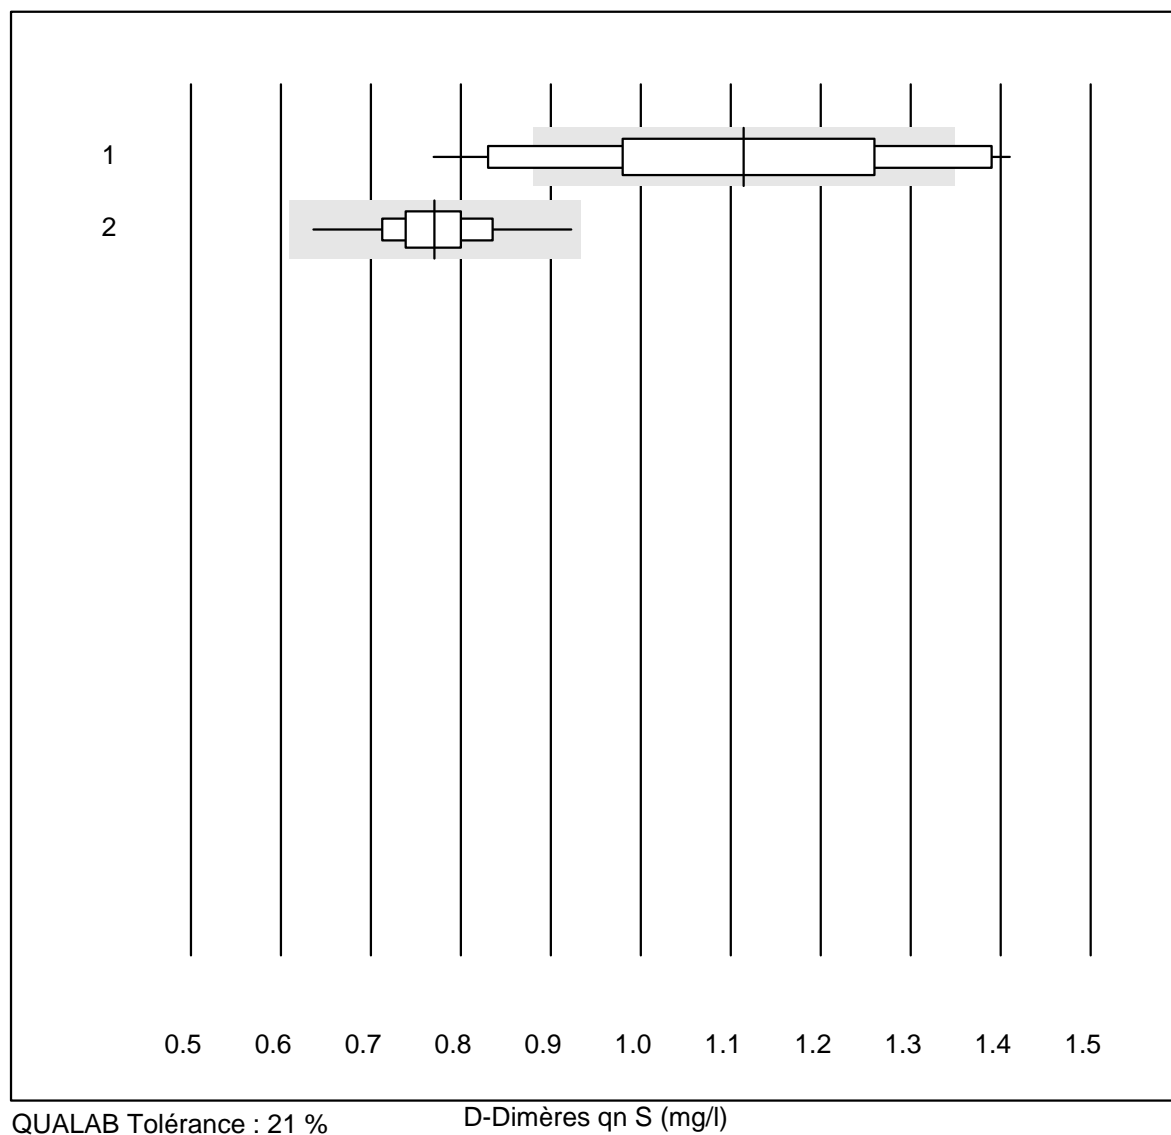


QUALAB Tolérance : 21 %

D-Dimères qn S (mg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Exdia TRF	37	62.2	18.9	18.9	1.11	16.6	e*
2 AFIAS	184	90.2	0.0	9.8	0.77	6.5	e

NT-proBNP S

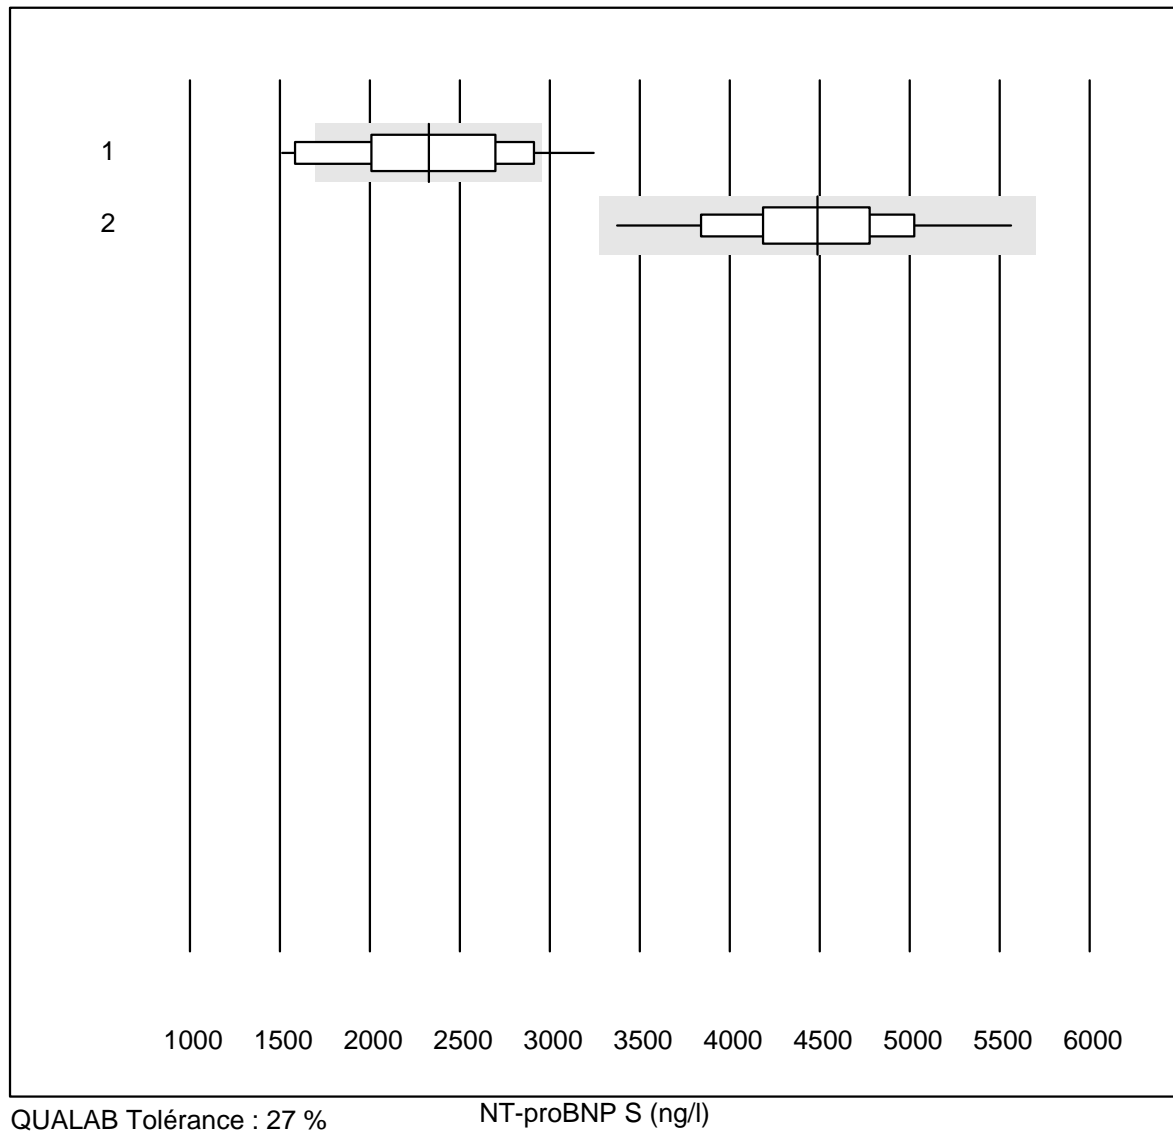


QUALAB Tolérance : 27 %

NT-proBNP S (ng/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Exdia TRF	34	70.6	20.6	8.8	2327.9	20.6	e*
2 AFIAS	139	98.6	0.0	1.4	4488.1	10.1	e

Lipase

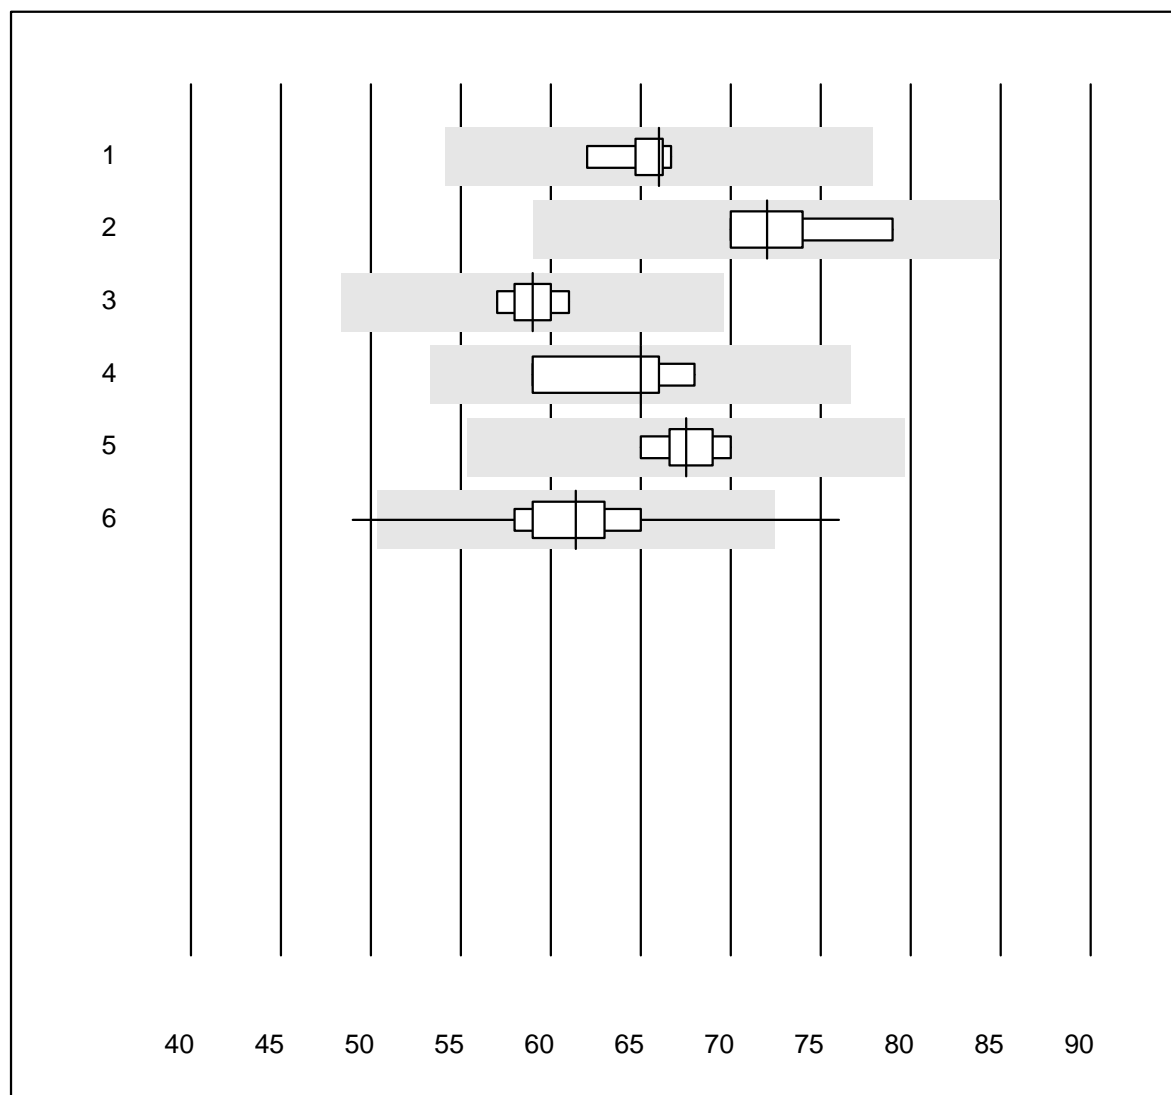


QUALAB Tolérance : 18 %

Lipase (U/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Roche	5	100.0	0.0	0.0	66.0	2.9	e
2 Alinity	6	100.0	0.0	0.0	72.0	4.6	e
3 Architect	5	100.0	0.0	0.0	59.0	2.7	e
4 Beckman	4	100.0	0.0	0.0	65.0	6.0	e*
5 Cobas	6	100.0	0.0	0.0	67.5	2.6	e
6 Fuji Dri-Chem	159	96.2	1.3	2.5	61.4	4.7	e

Bicarbonat

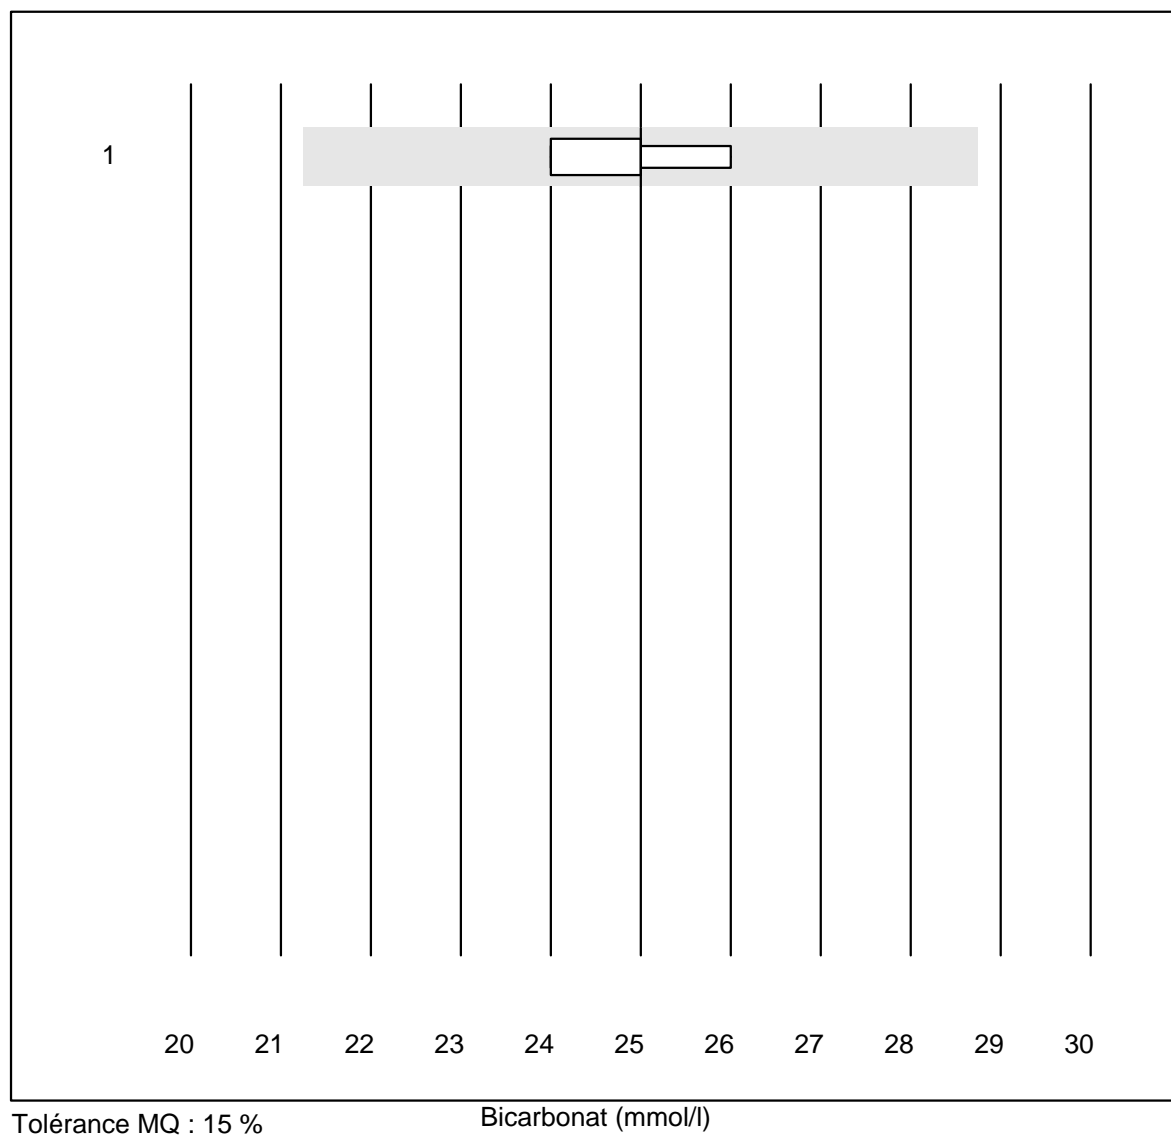


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Piccolo	4	100.0	0.0	0.0	25.0	3.3	e

Cholinestérase

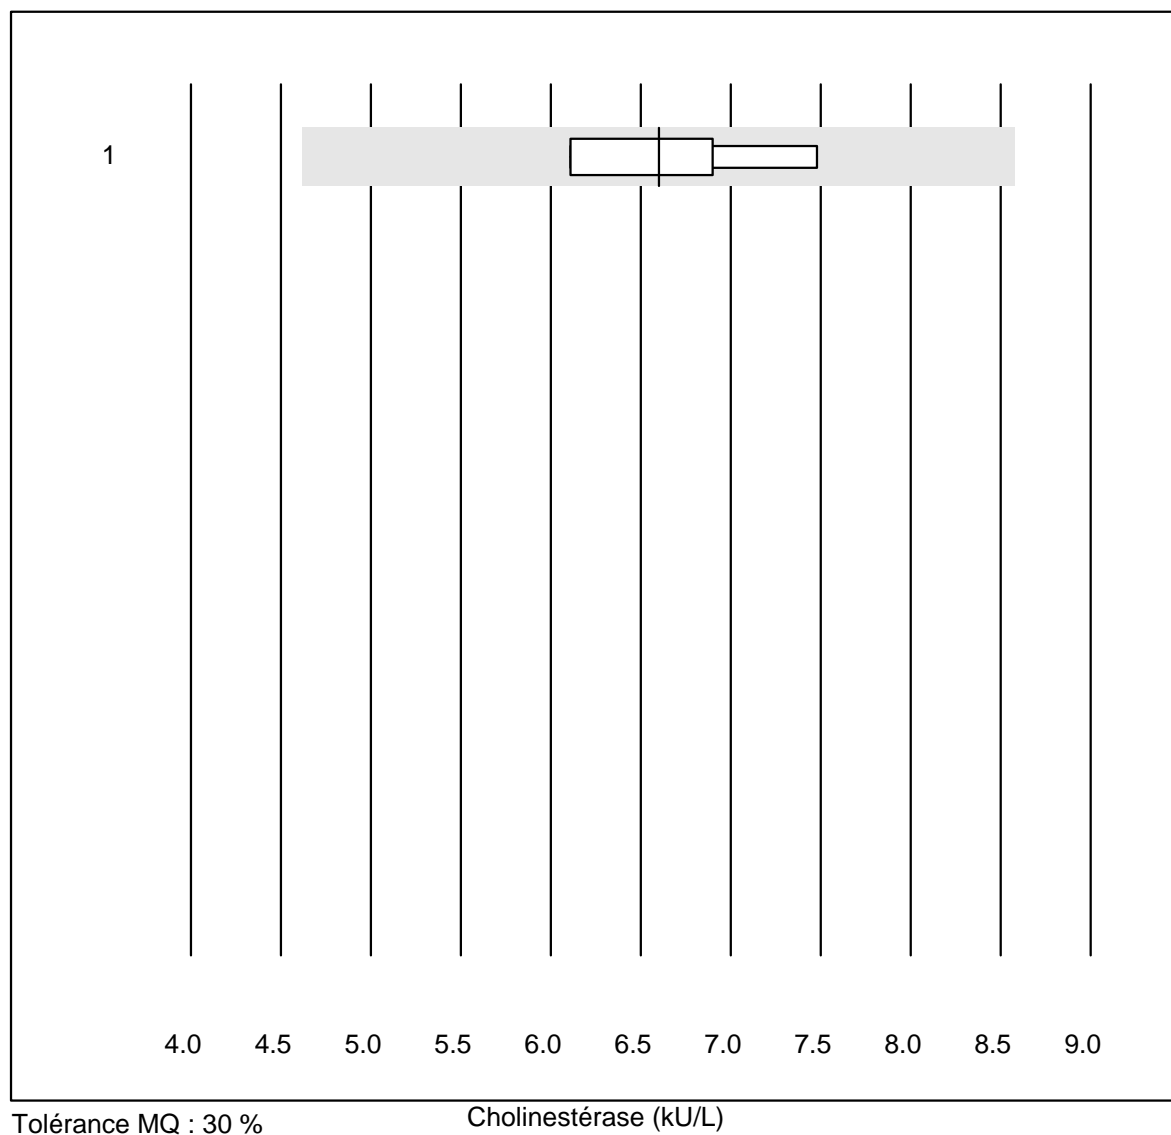

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	6.6	9.3	e*

Glucose CSF

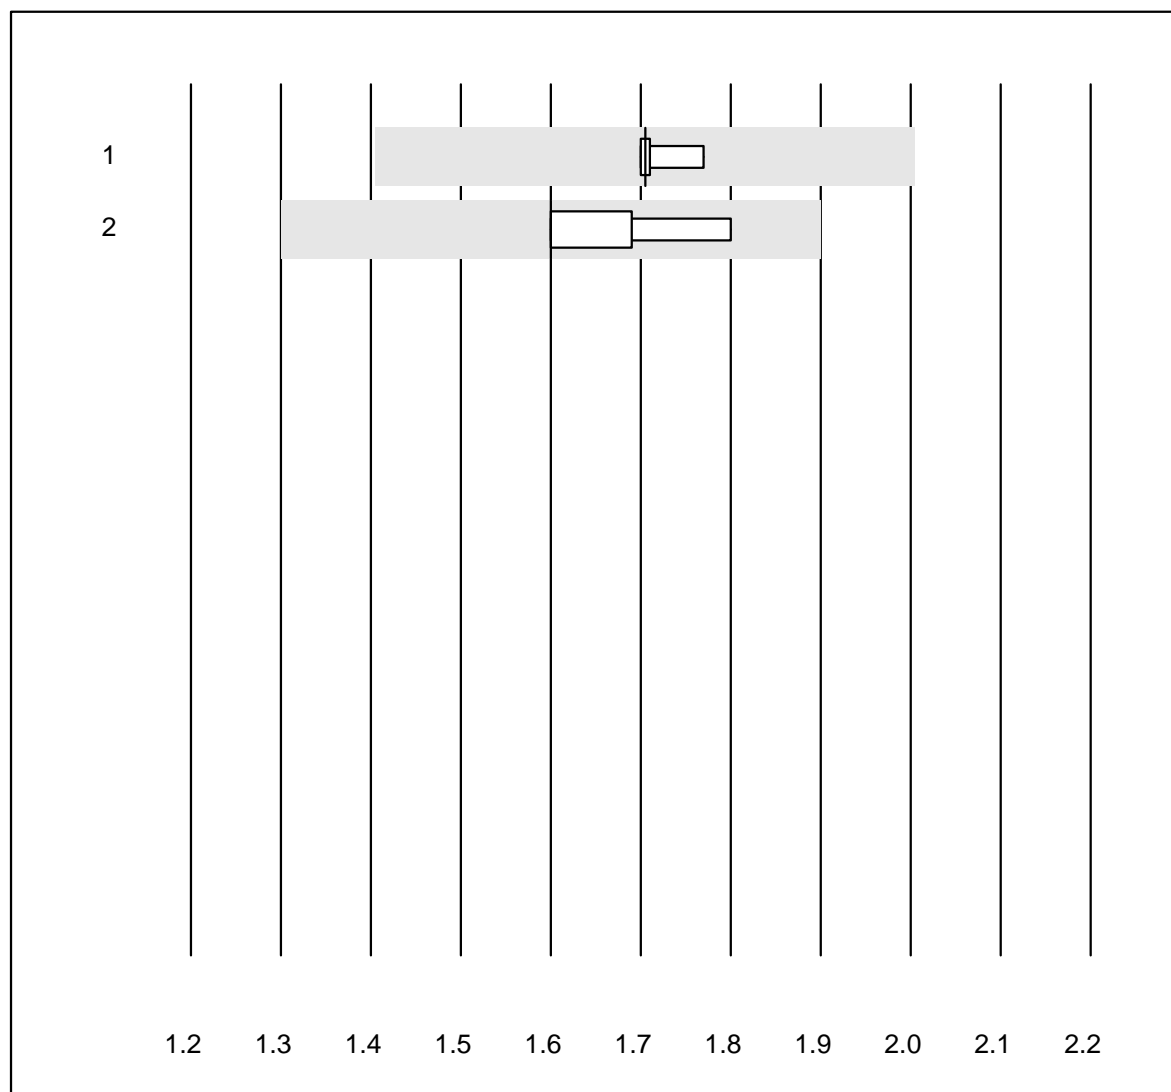


QUALAB Tolérance : 9 %
(< 3.30: +/- 0.30 mmol/l)

Glucose CSF (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	1.71	2.0	e
2 Autres méthodes	9	100.0	0.0	0.0	1.60	4.4	e*

Lactate CSF

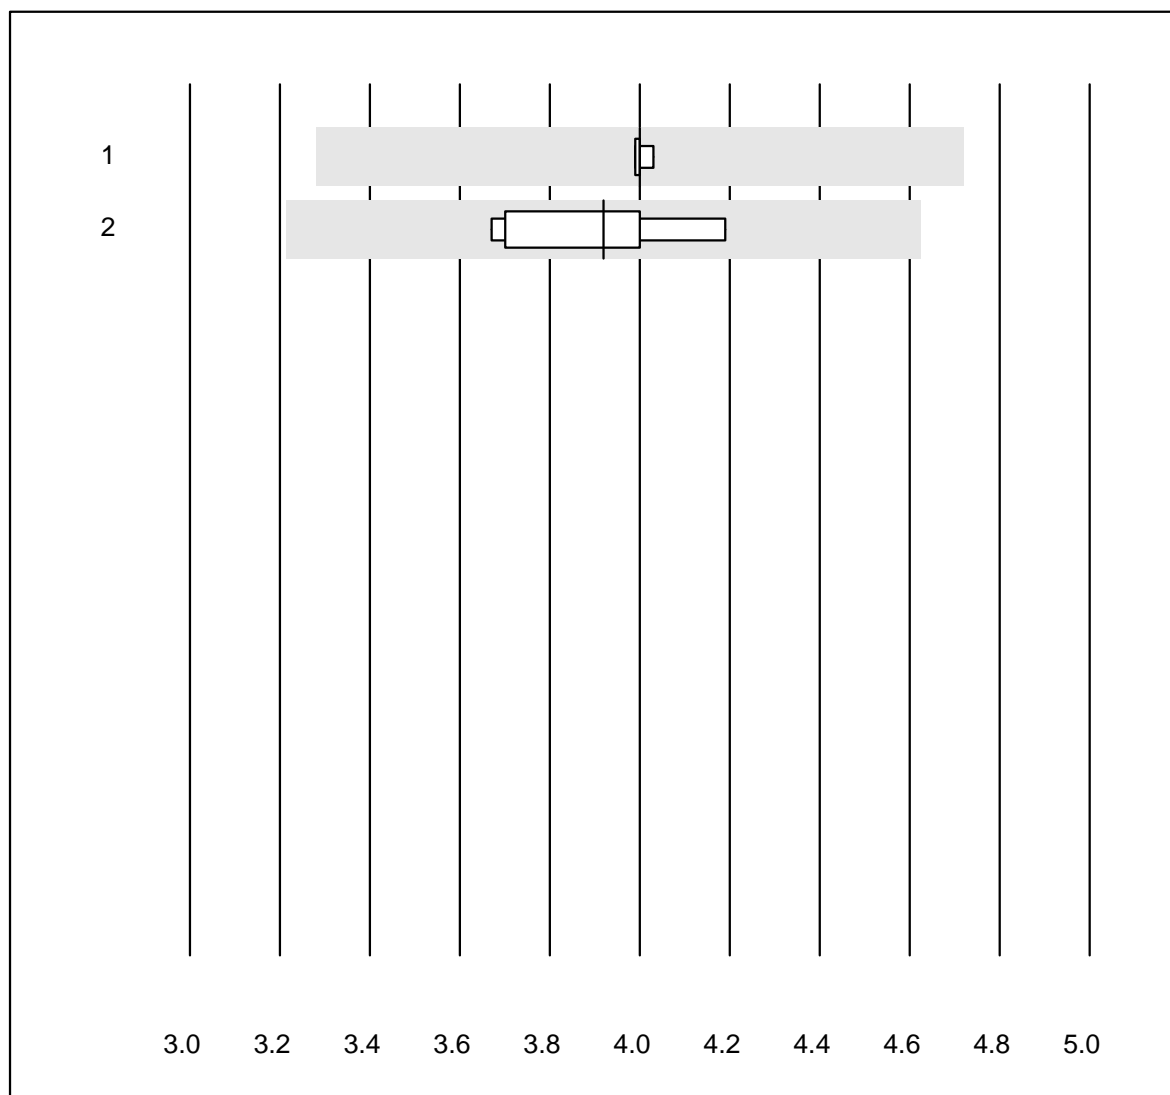


QUALAB Tolérance : 18 %

Lactate CSF (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	4.00	0.4	e
2 Autres méthodes	7	100.0	0.0	0.0	3.92	4.6	e

Protéine CSF

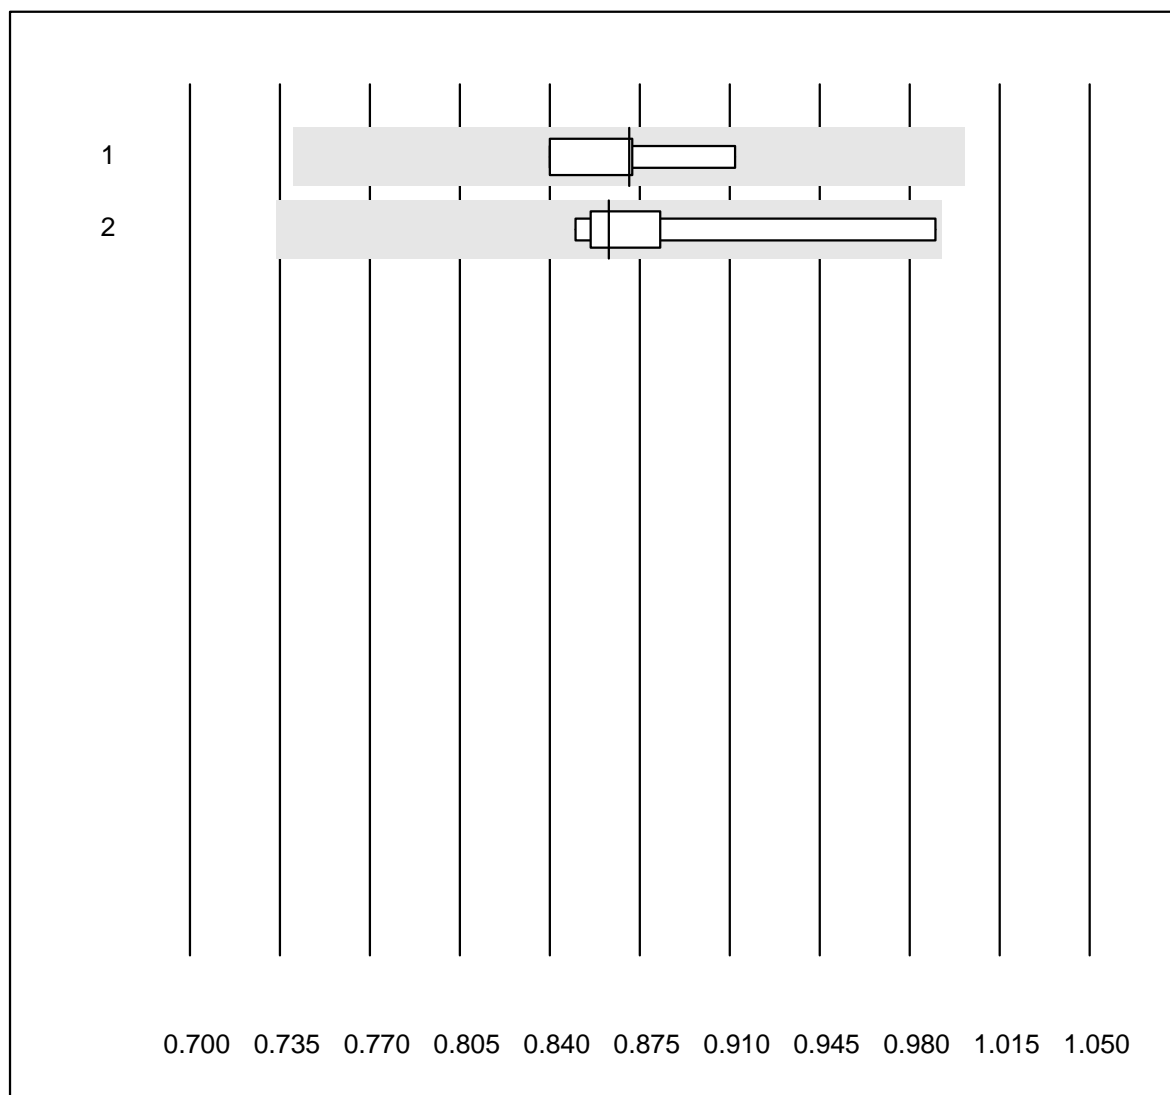


QUALAB Tolérance : 15 %

Protéine CSF (g/l)


No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	0.87	3.4	e
2 Autres méthodes	7	100.0	0.0	0.0	0.86	5.5	e*

Tacrolimus

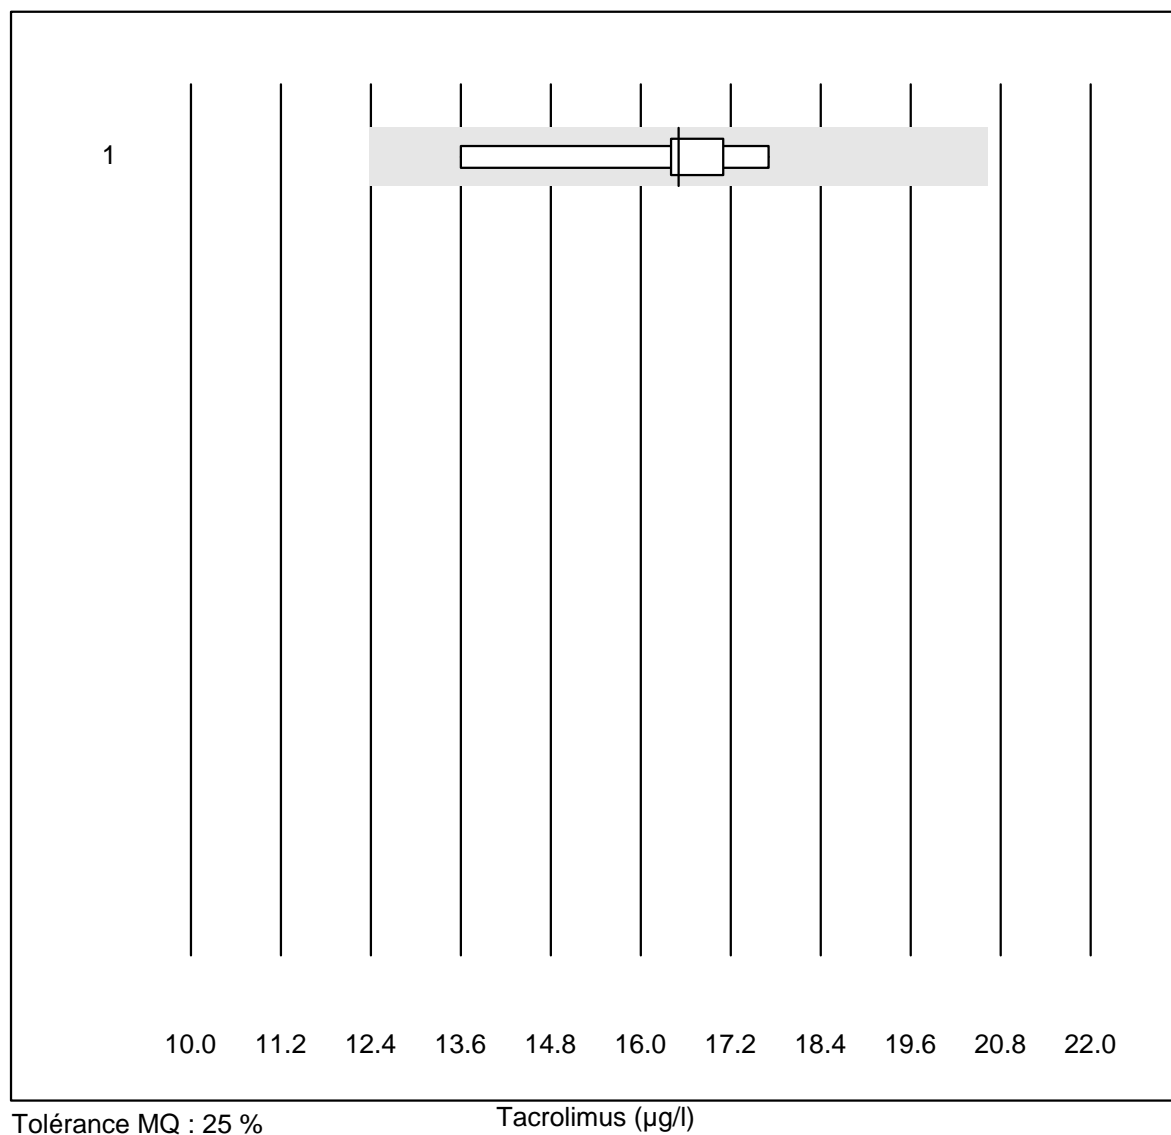

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	9	100.0	0.0	0.0	16.5	7.2	e

Totalprotein E

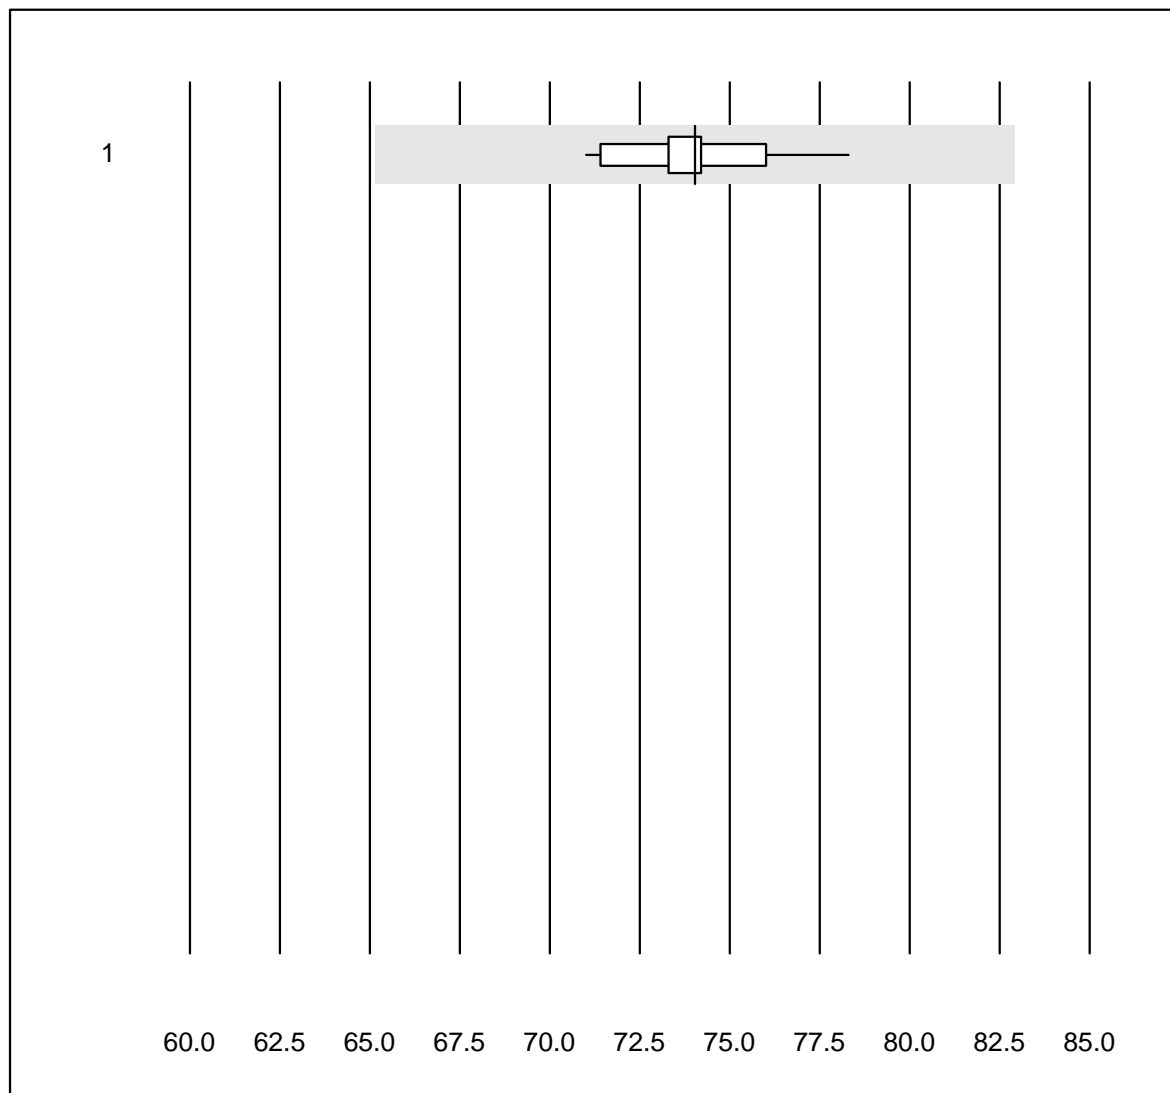


Tolérance MQ : 12 %

Totalprotein E (g/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	13	100.0	0.0	0.0	74.0	2.5	e

Albumin E

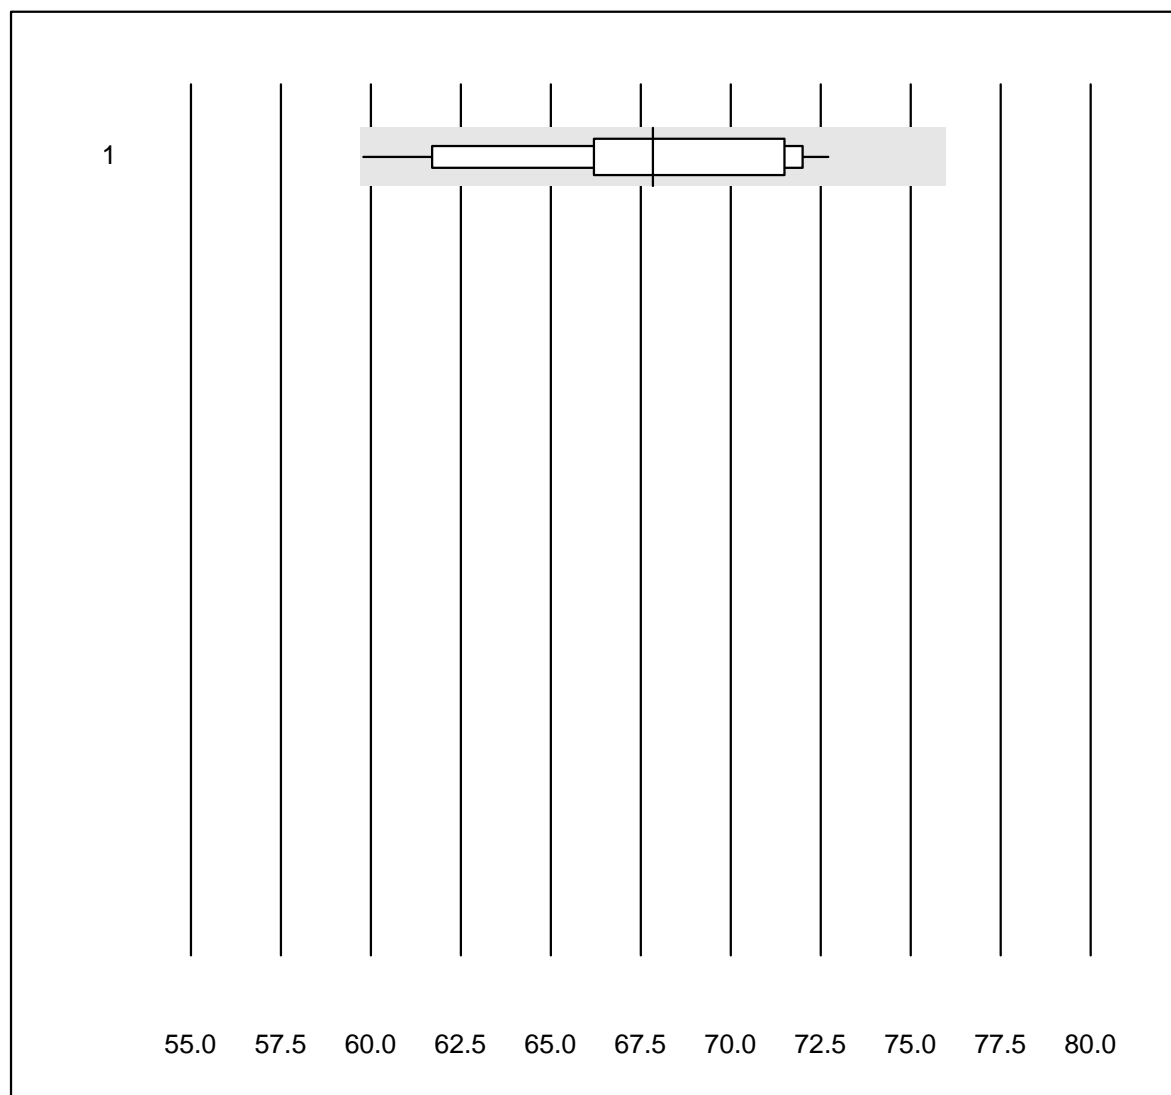


Tolérance MQ : 12 %

Albumin E (%)


No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 électrophorèse	20	100.0	0.0	0.0	67.8	5.5	e

alpha-1-Globuline

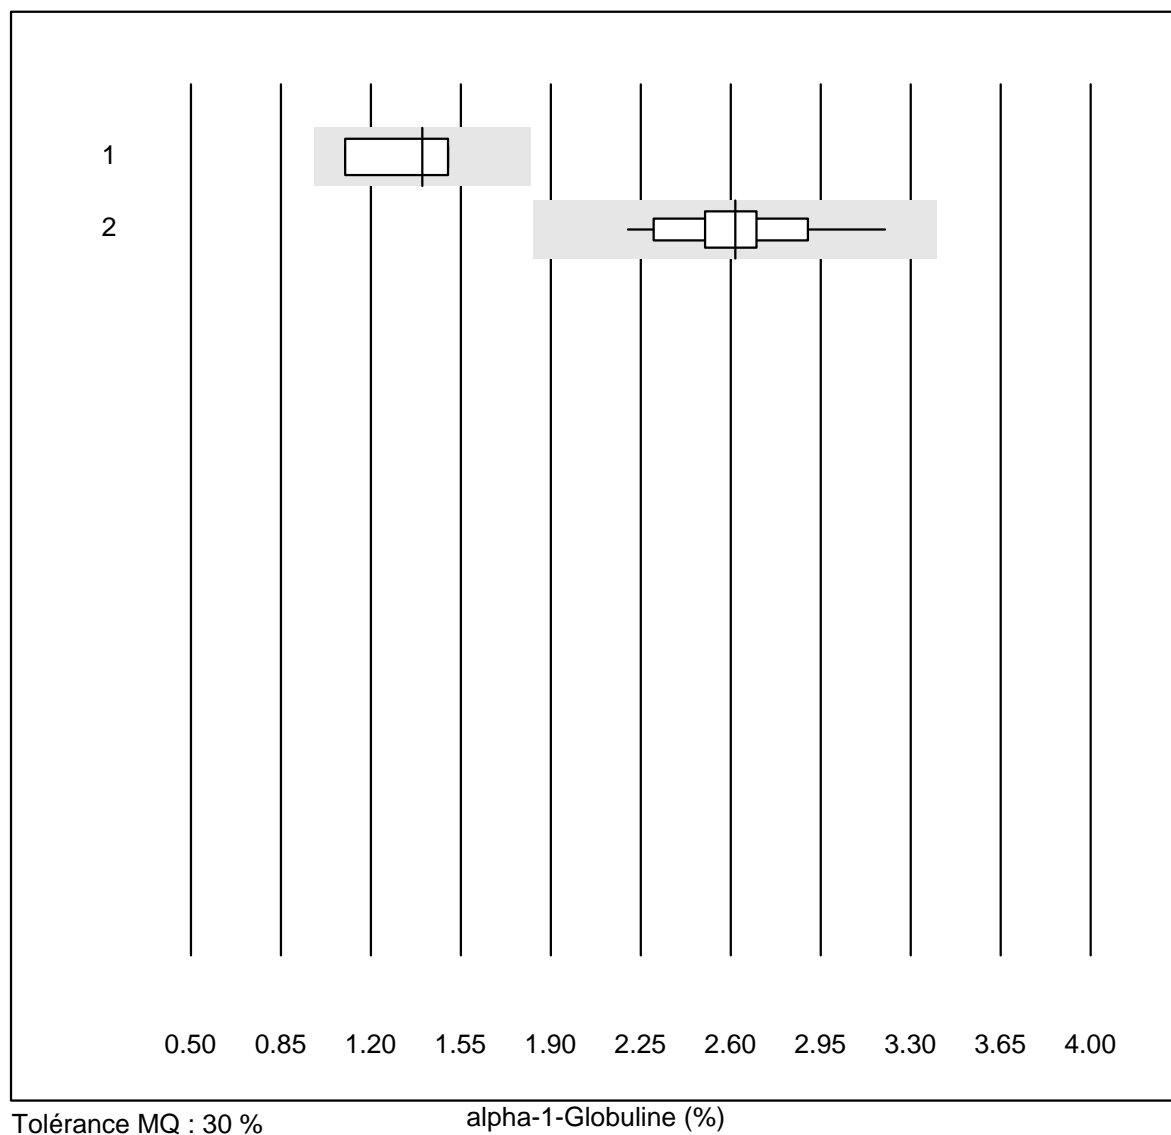

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 électrophorèse	7	100.0	0.0	0.0	1.4	12.8	e*
2 électrophorèse capil	12	100.0	0.0	0.0	2.6	10.1	e

alpha-2-Globuline

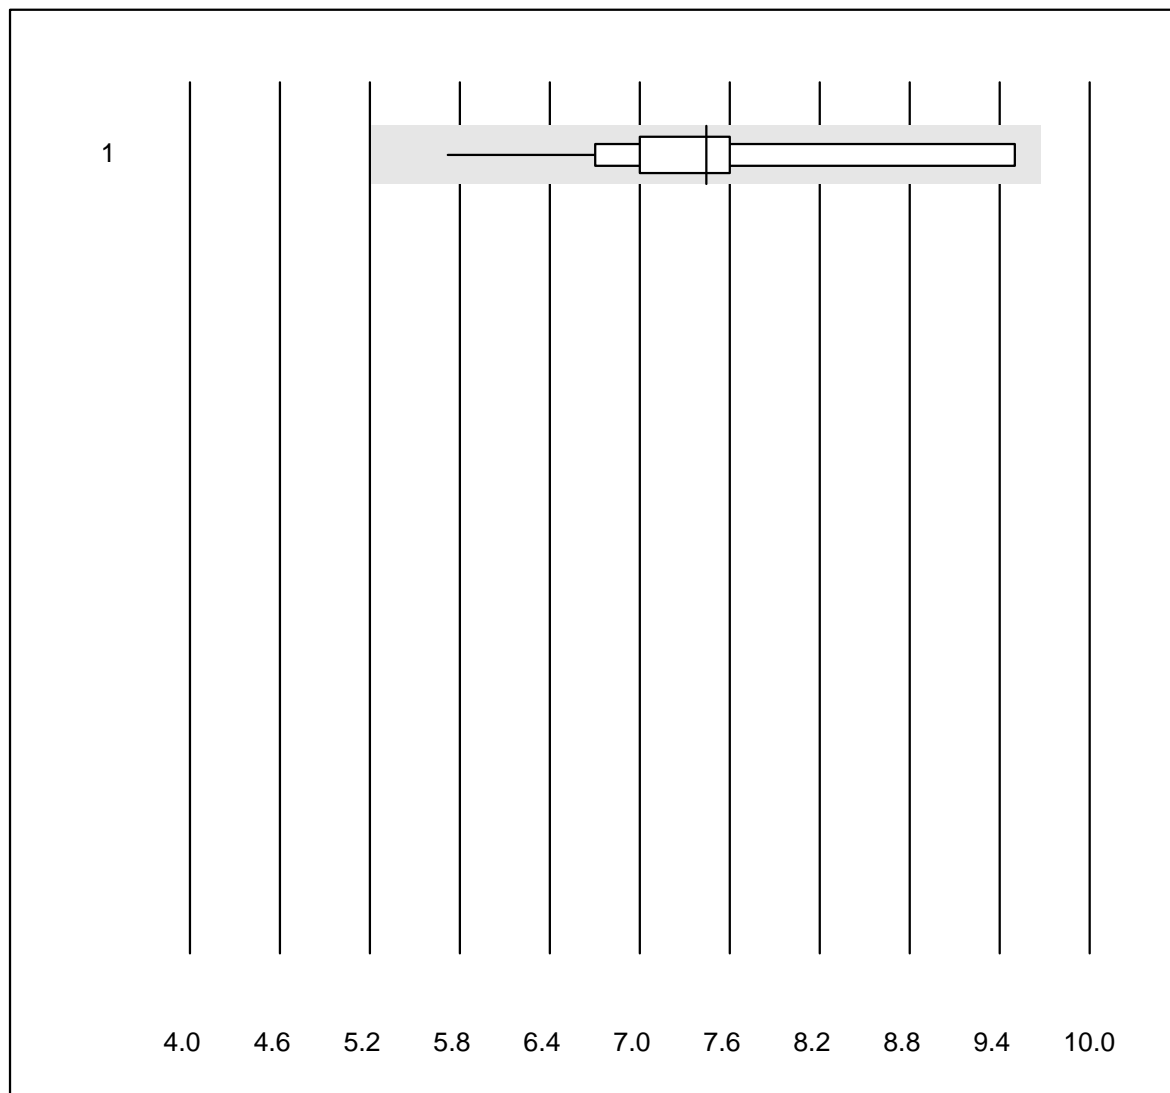


Tolérance MQ : 30 %

alpha-2-Globuline (%)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 électrophorèse	19	94.7	0.0	5.3	7.4	13.0	e

beta-Globuline

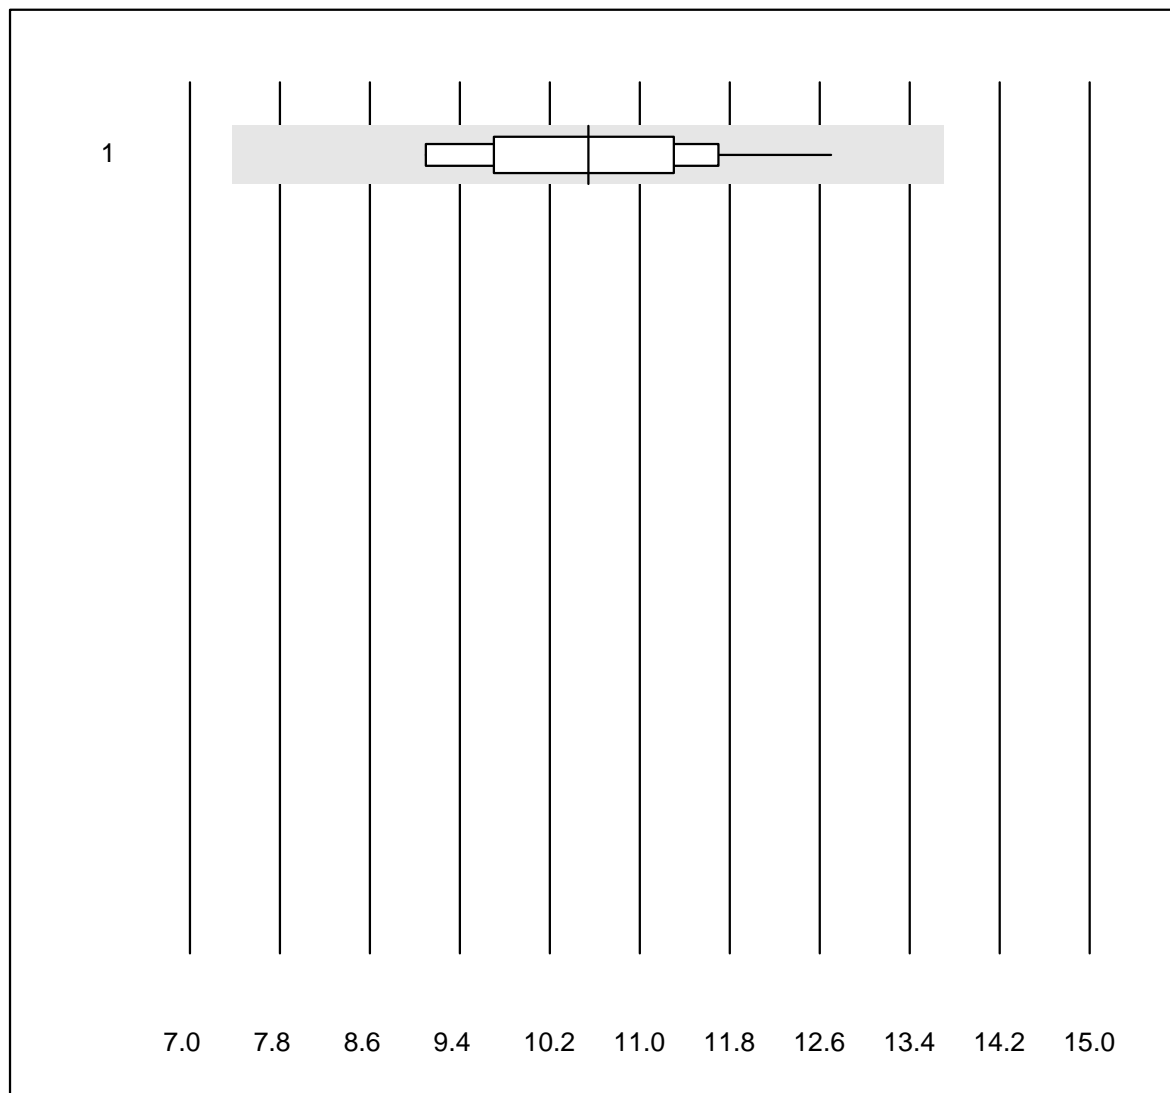


Tolérance MQ : 30 %

beta-Globuline (%)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 électrophorèse	15	100.0	0.0	0.0	10.5	9.9	e

Beta-1-Globulin

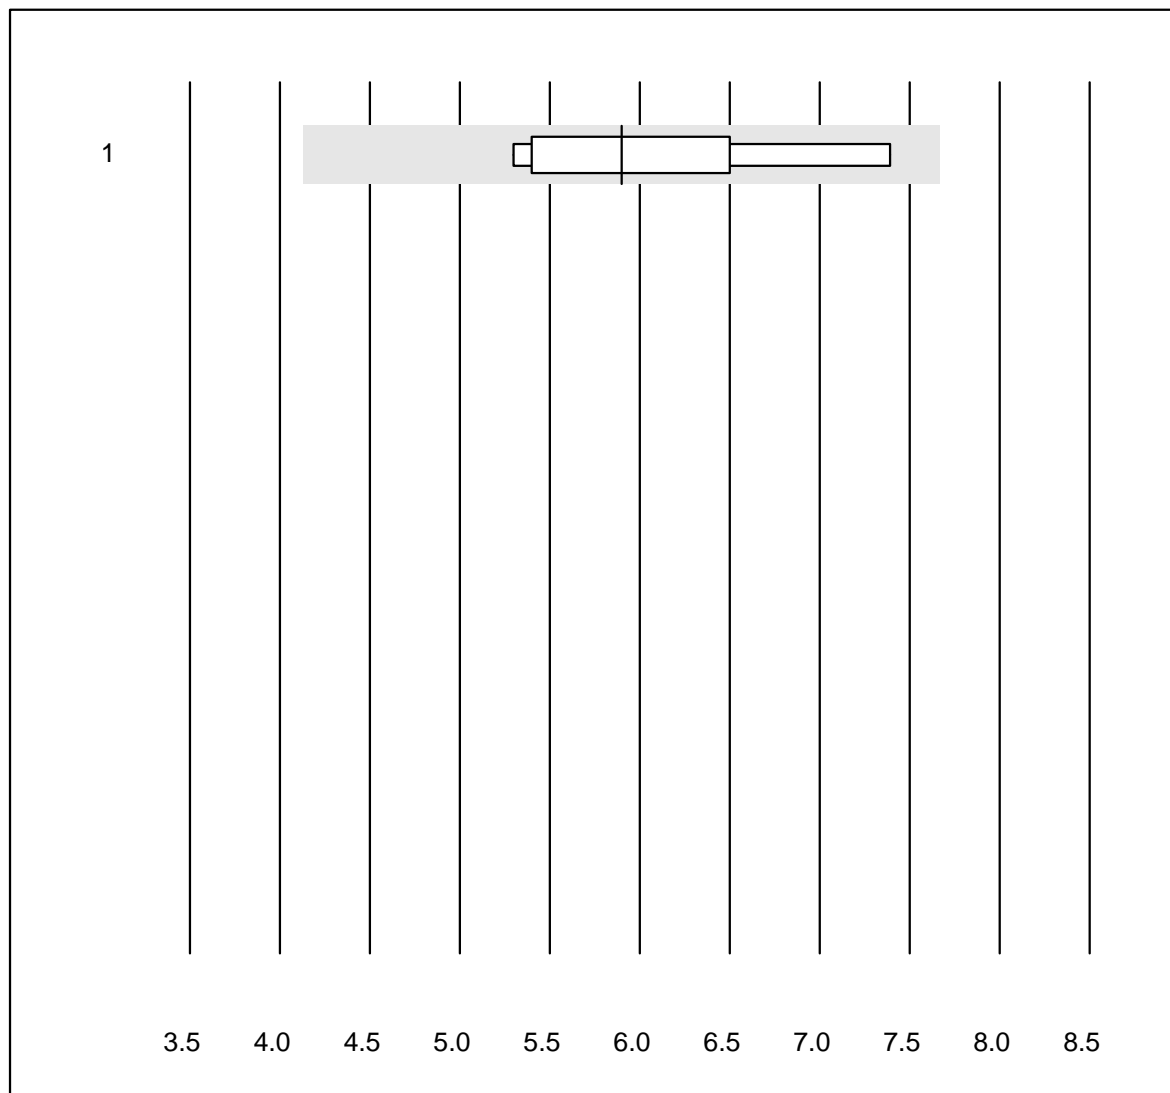


Tolérance MQ : 30 %

Beta-1-Globulin (%)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 électrophorèse	7	100.0	0.0	0.0	5.9	12.0	e*

Beta-2-Globulin

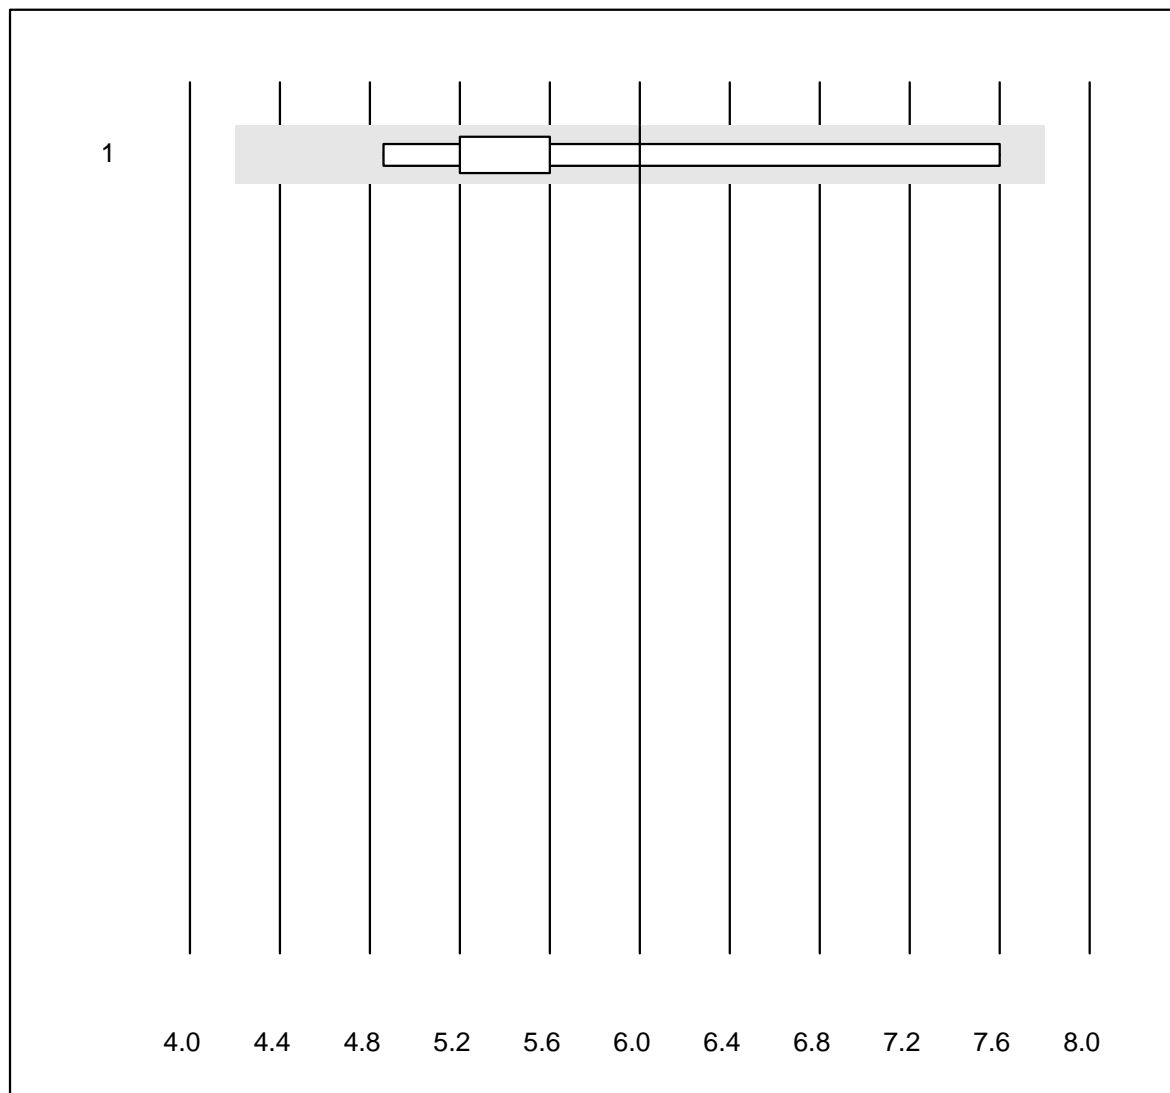


Tolérance MQ : 30 %

Beta-2-Globulin (%)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 électrophorèse	8	100.0	0.0	0.0	6.0	14.7	a

gamma-Globuline

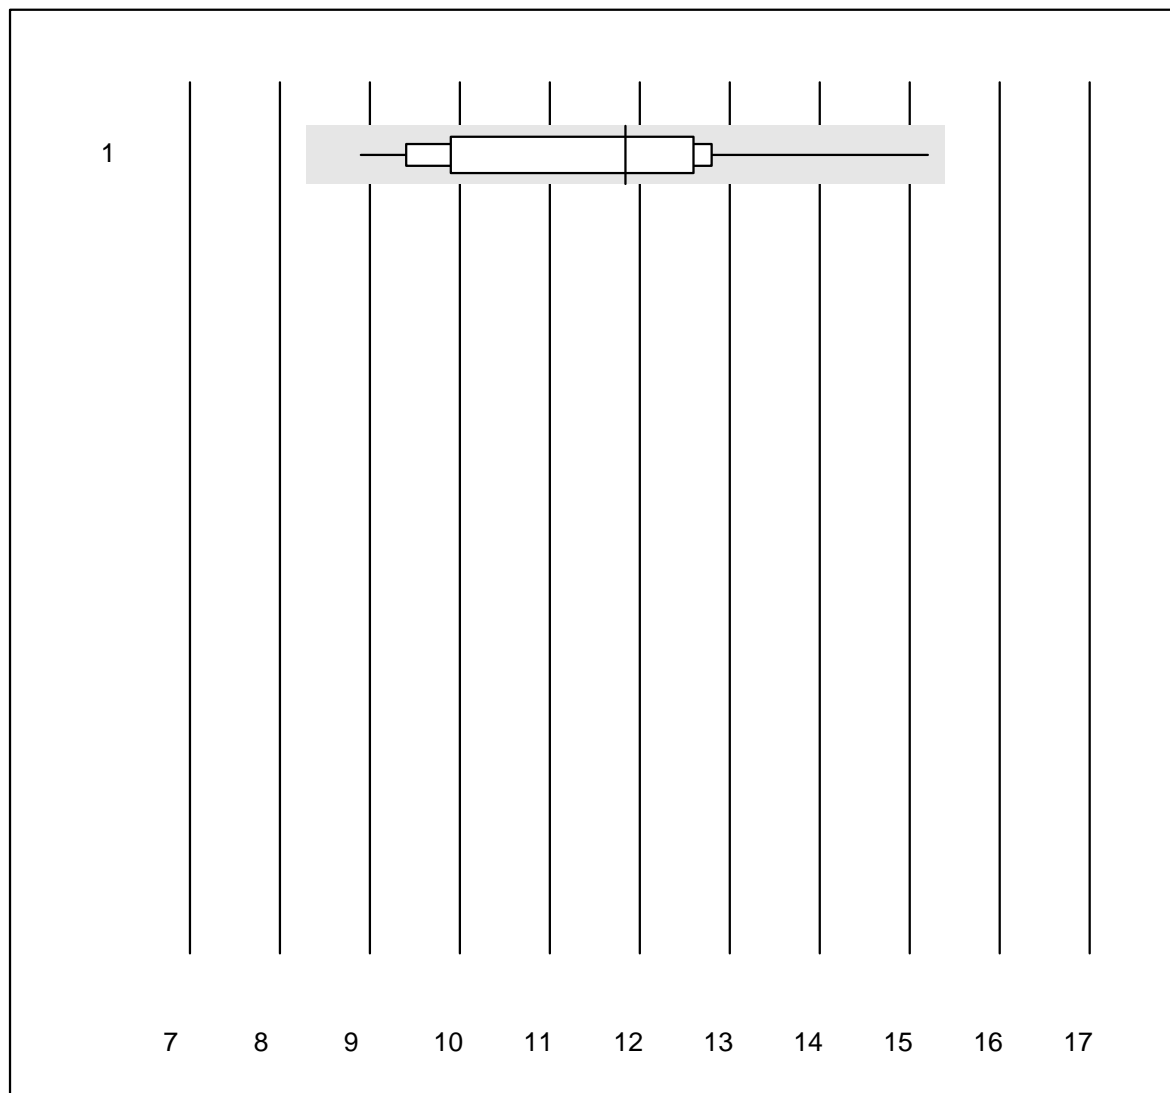


Tolérance MQ : 30 %

gamma-Globuline (%)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 électrophorèse	16	100.0	0.0	0.0	11.8	13.6	e

Gamma-Globuline+P

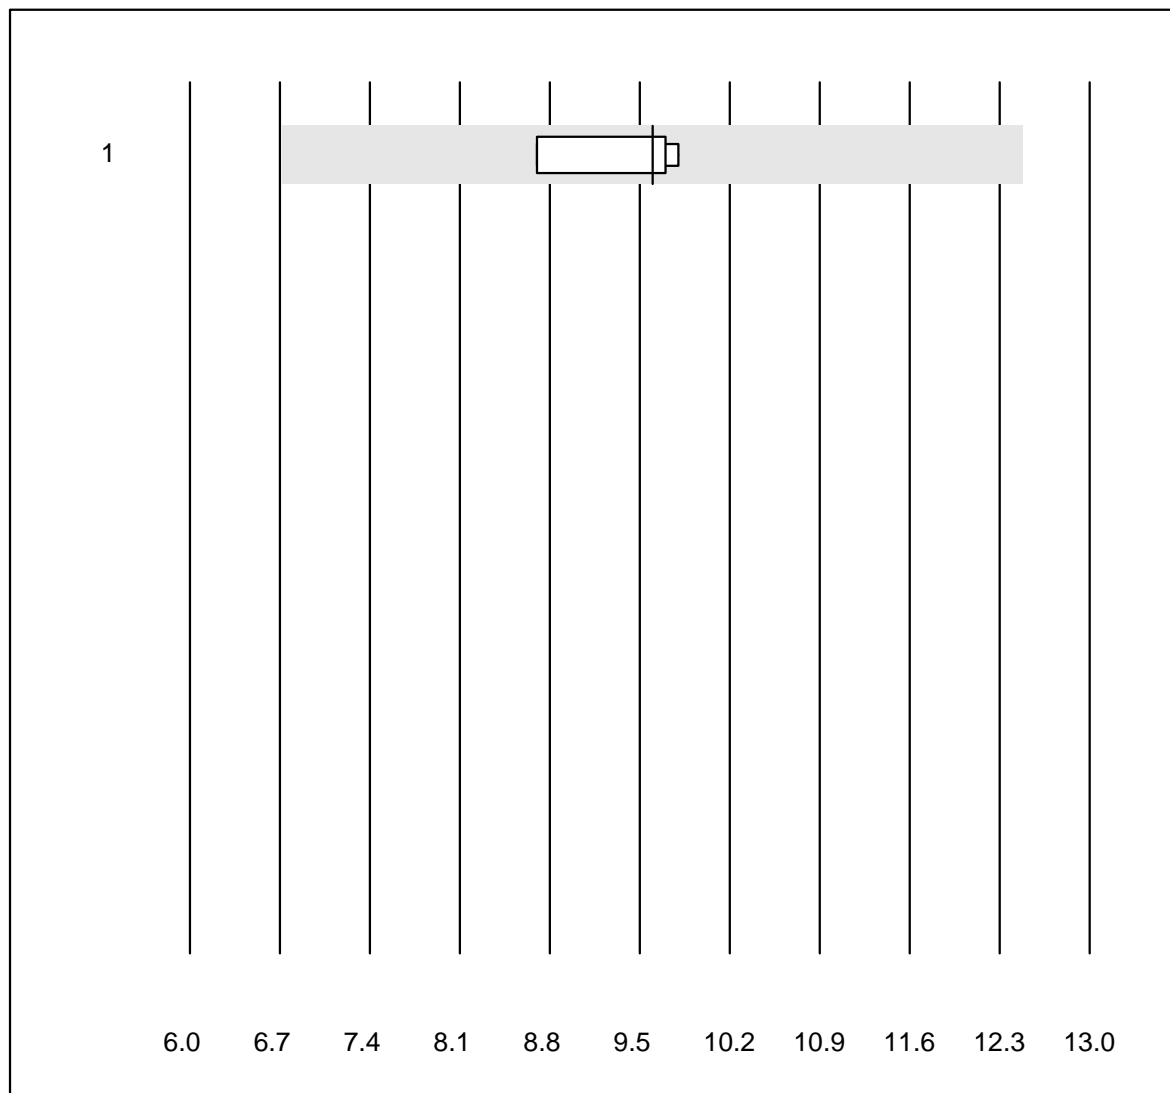


Tolérance MQ : 30 %

Gamma-Globuline+P (%)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 électrophorèse	4	100.0	0.0	0.0	9.6	5.3	e

Immunfixation

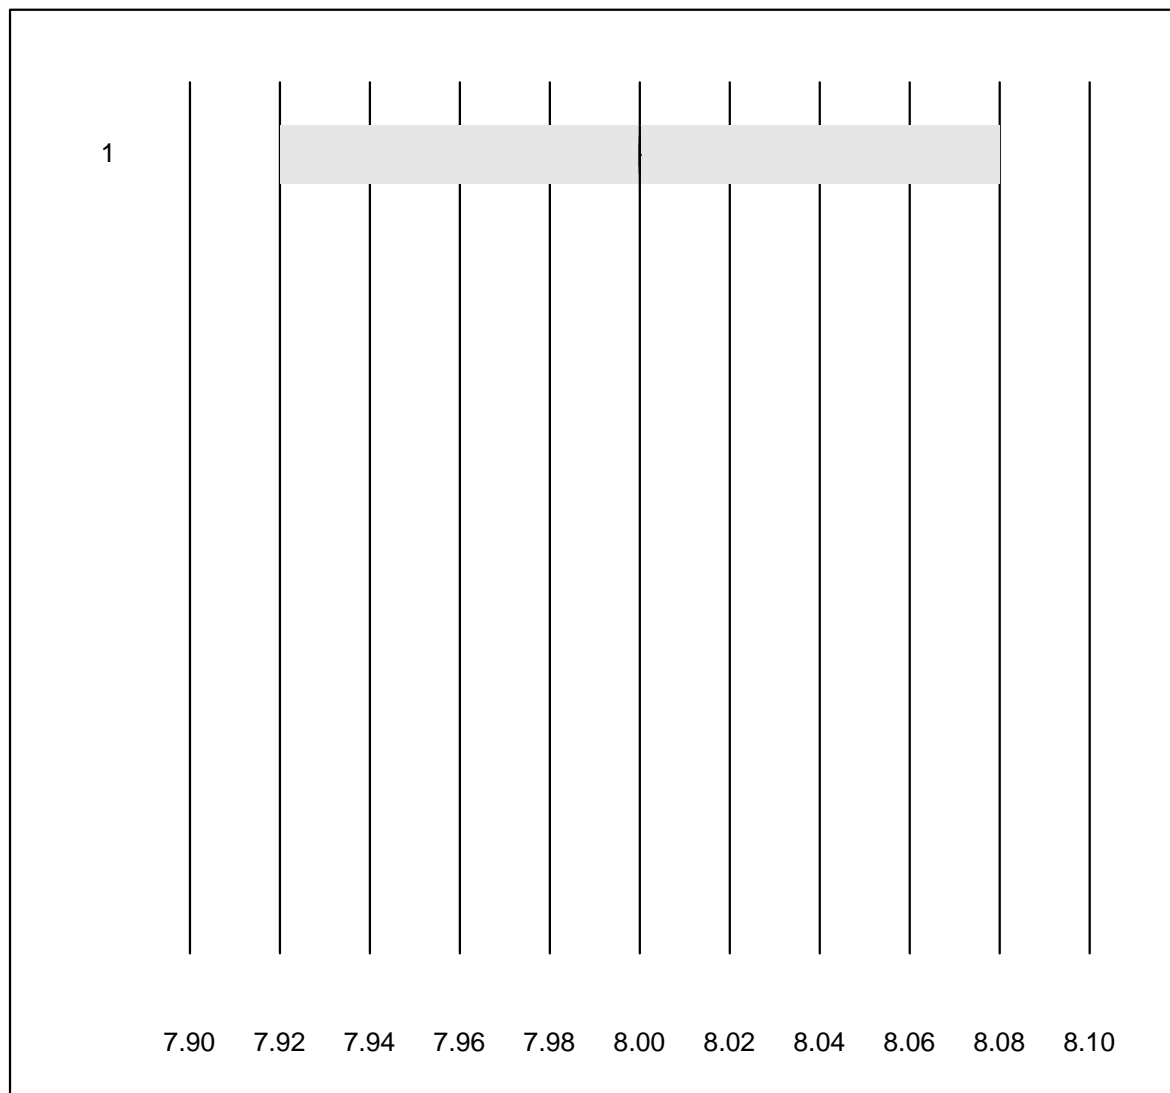


QUALAB Tolérance : 1 %

Immunfixation (Code)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 interprétation	16	87.5	0.0	12.5	8	0.0	e

Folates érythrocytaires

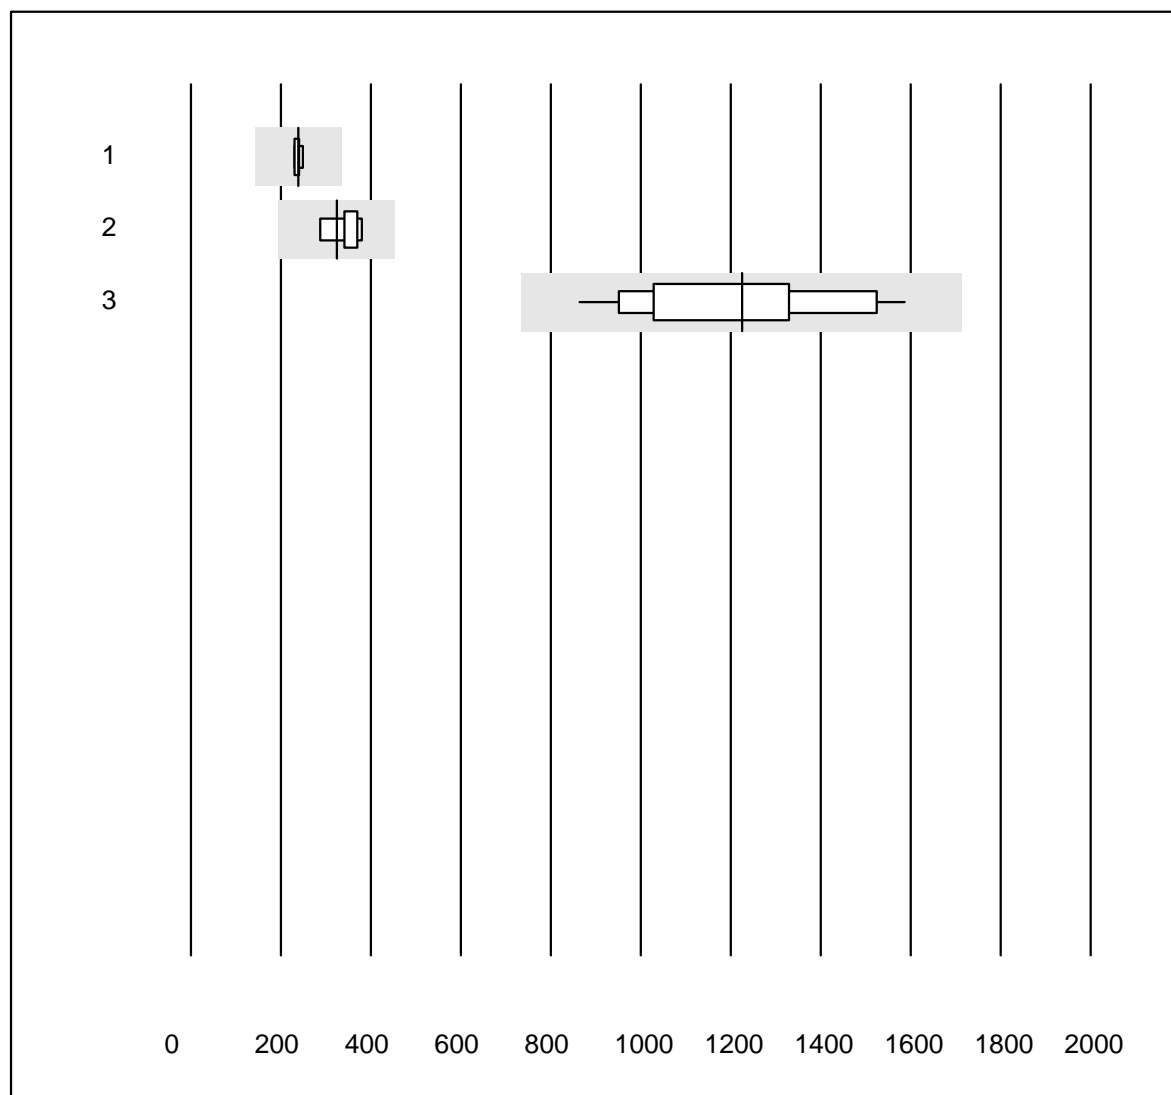


Tolérance MQ : 40 %

Folates érythrocytaires (nmol/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Alinity	5	100.0	0.0	0.0	239	3.2	a
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	324	10.6	a
3 Cobas	13	100.0	0.0	0.0	1225	19.3	a

Gallensäure

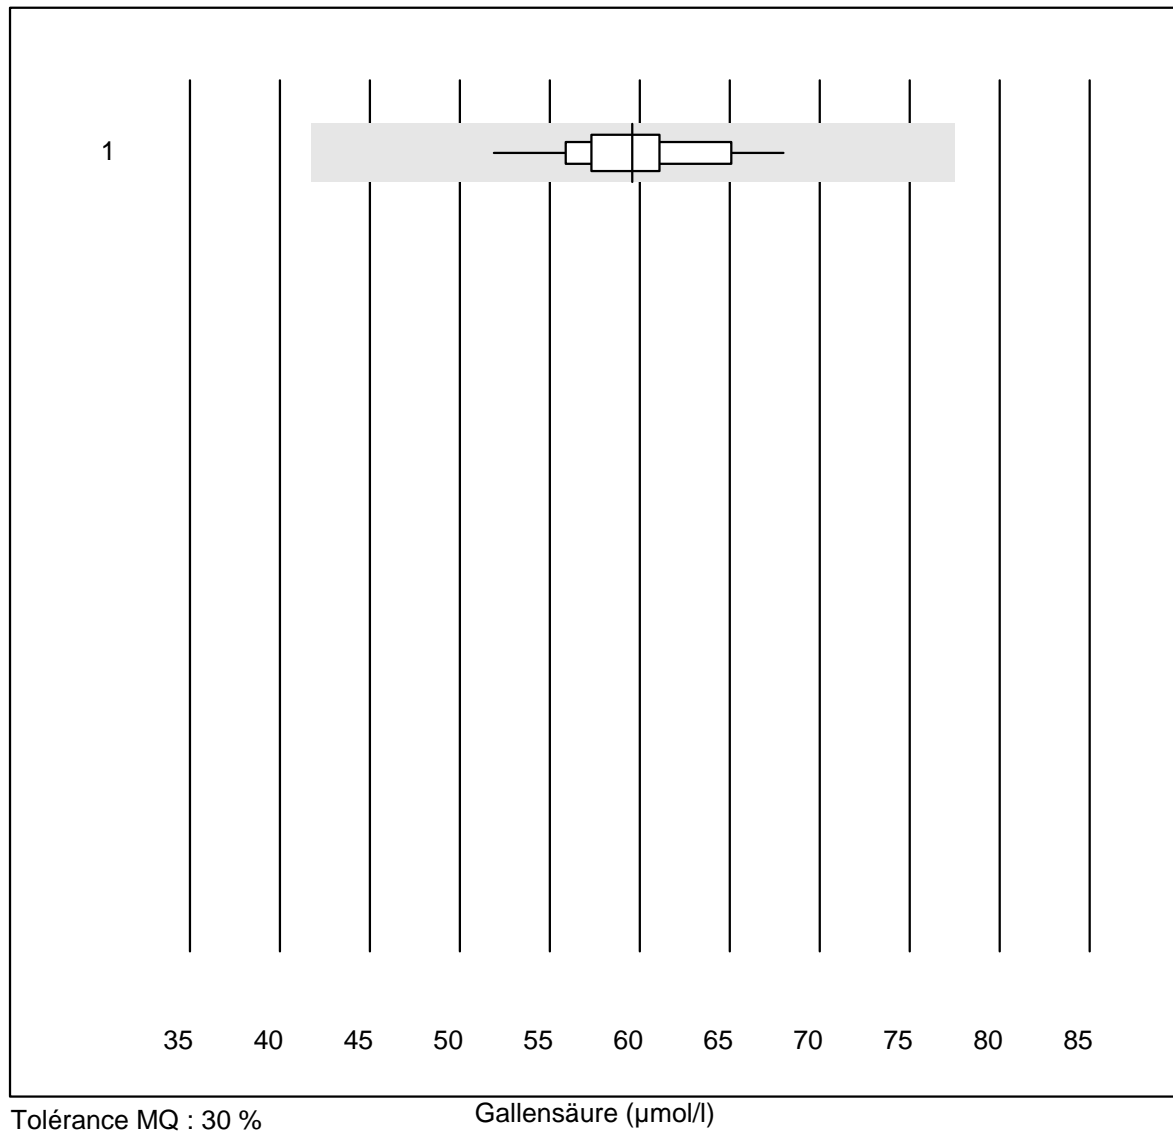

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	13	100.0	0.0	0.0	59.6	7.3	e

BNP

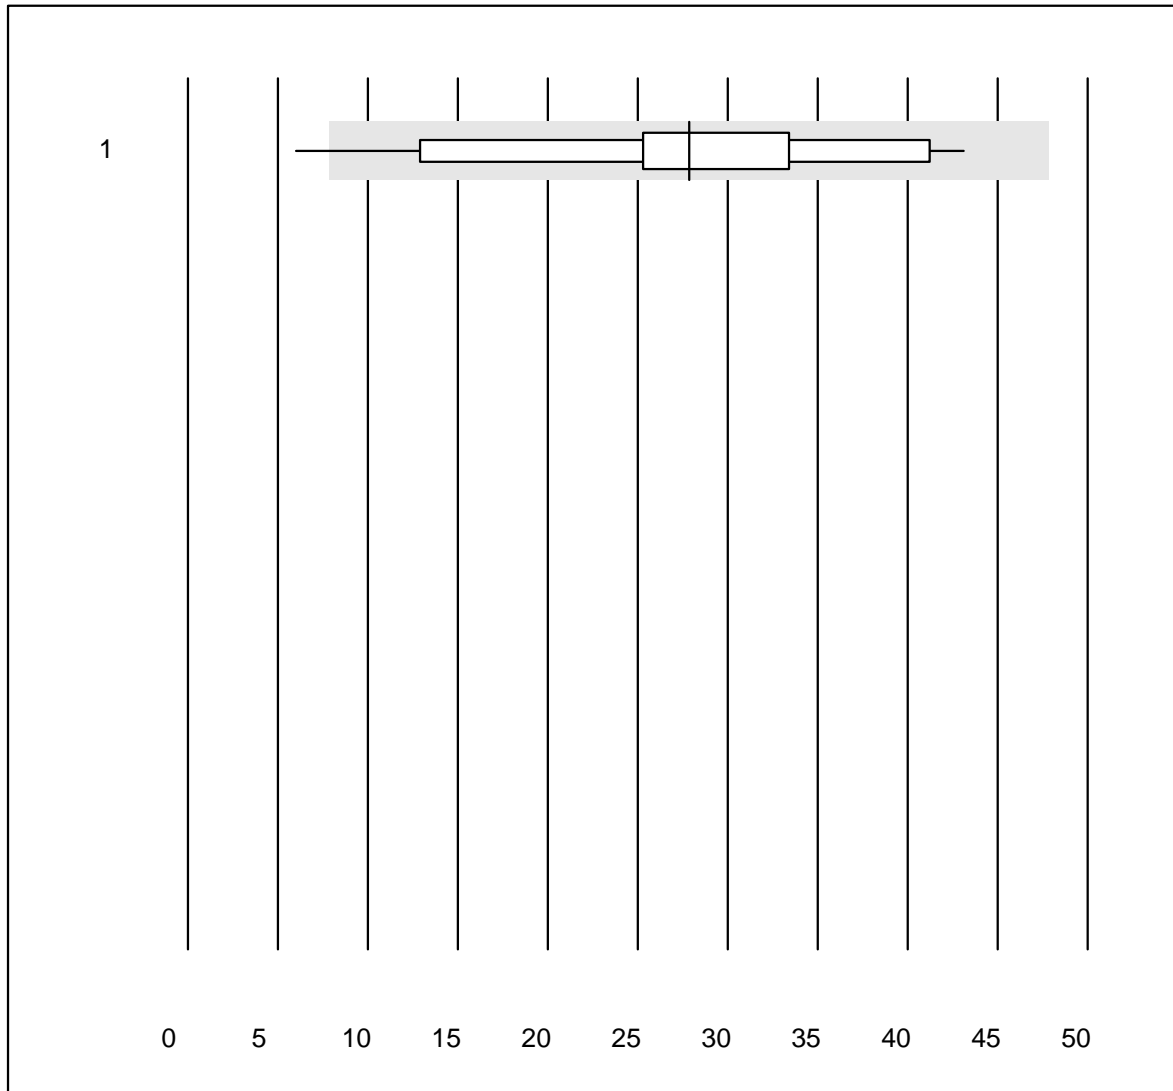


QUALAB Tolérance : 27 %
 (< 75.0: +/- 20.0 ng/l)

BNP (ng/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Triage	20	85.0	5.0	10.0	27.9	31.7	e*

Troponin Triage

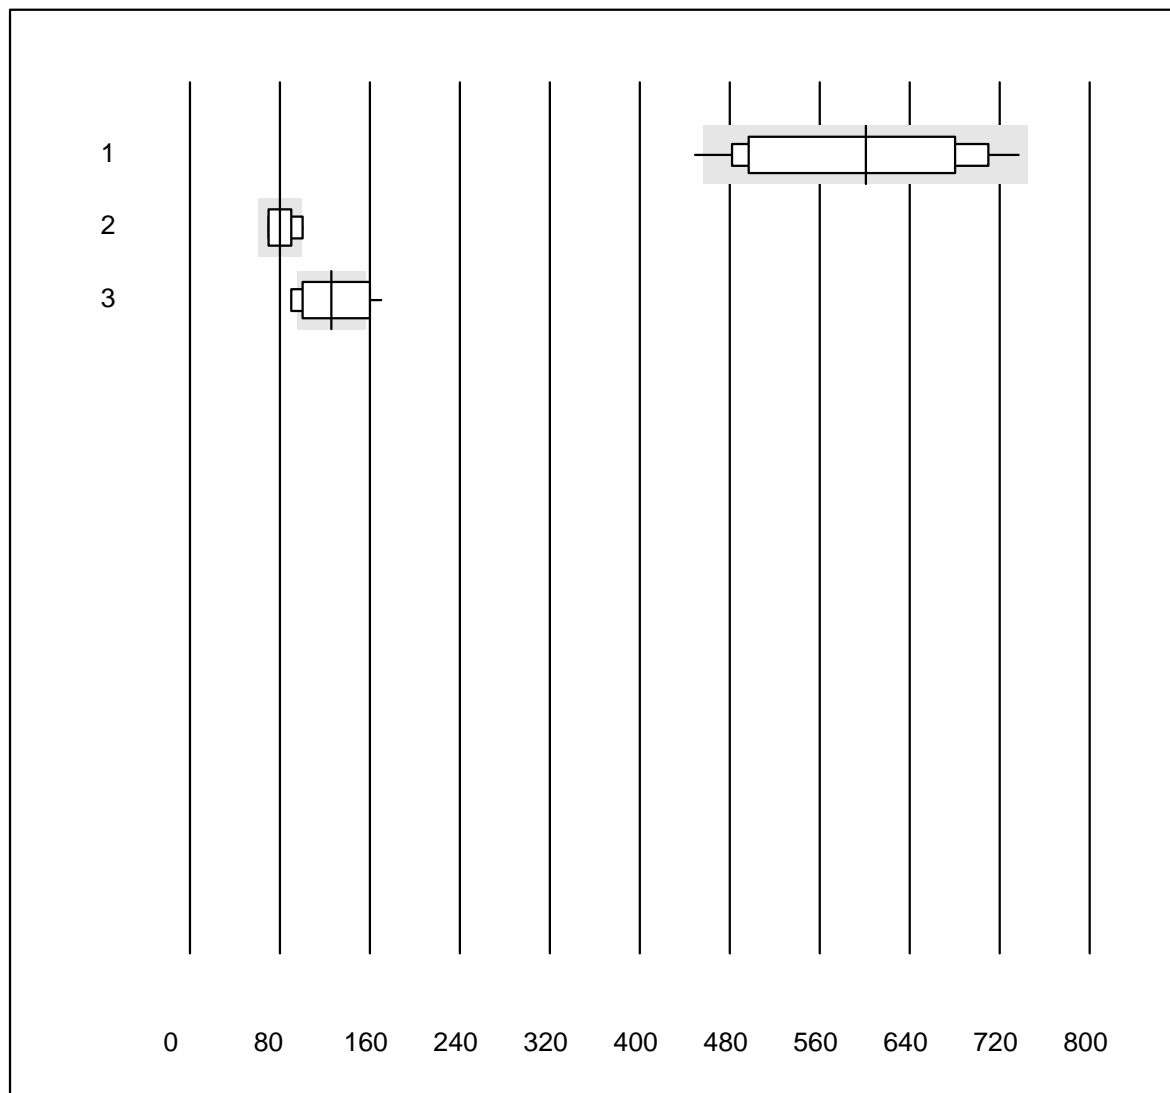


QUALAB Tolérance : 24 %

Troponin Triage (ng/l)


No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	Triage high sensitiv	16	87.4	6.3	6.3	600.80	15.4	e*
2	Triage SOB/Cardiac	7	71.4	14.3	14.3	80.00	14.3	e*
3	Triage Next Gen	17	35.3	23.5	41.2	126.00	22.5	e*

NT-pro BNP

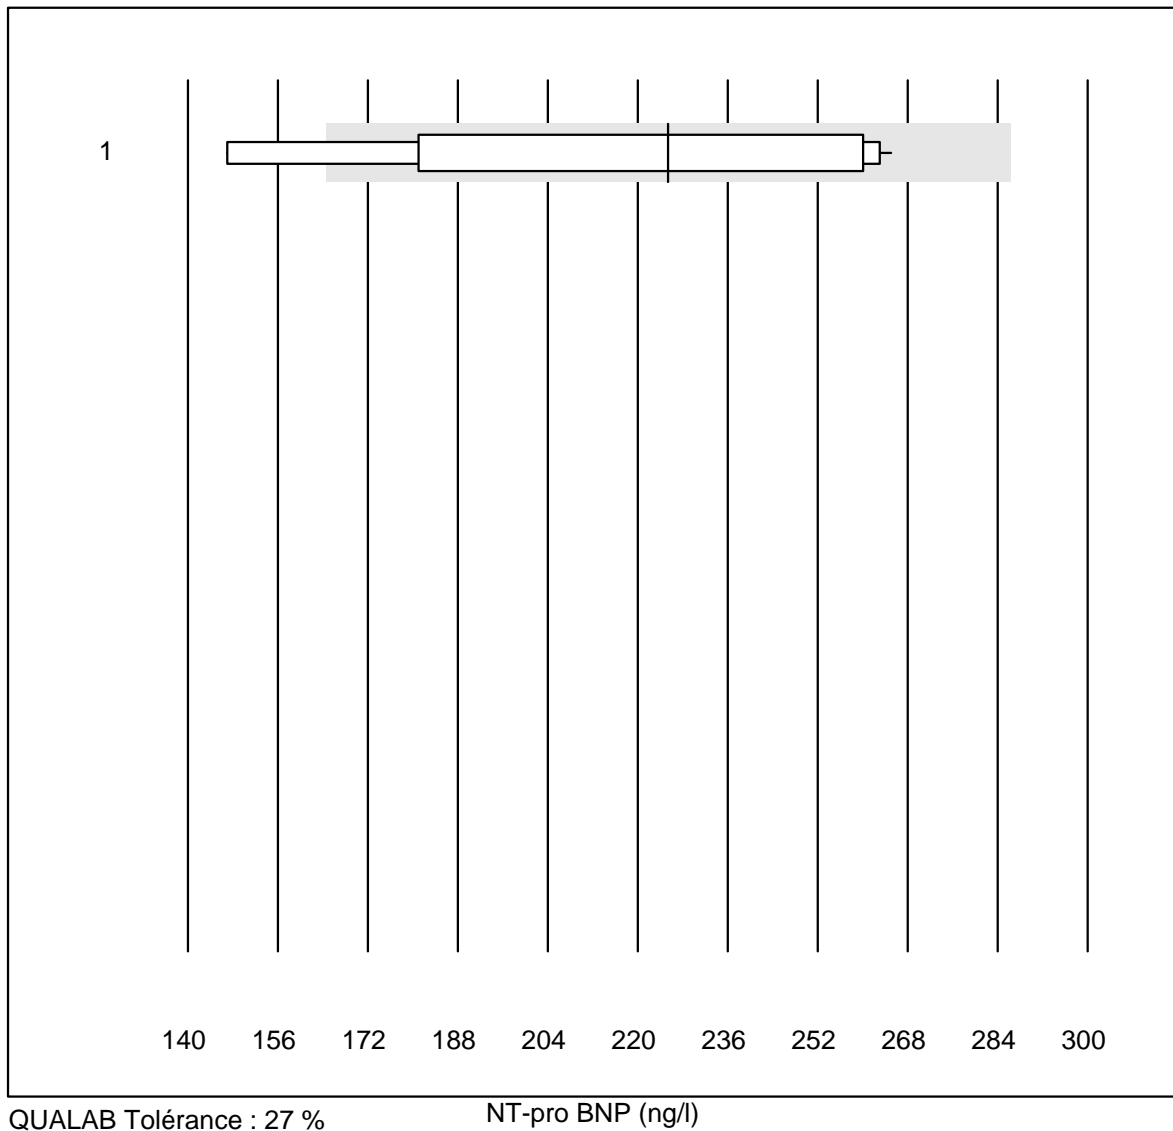

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Triage	10	90.0	10.0	0.0	225	18.9	e*

D-Dimere Triage

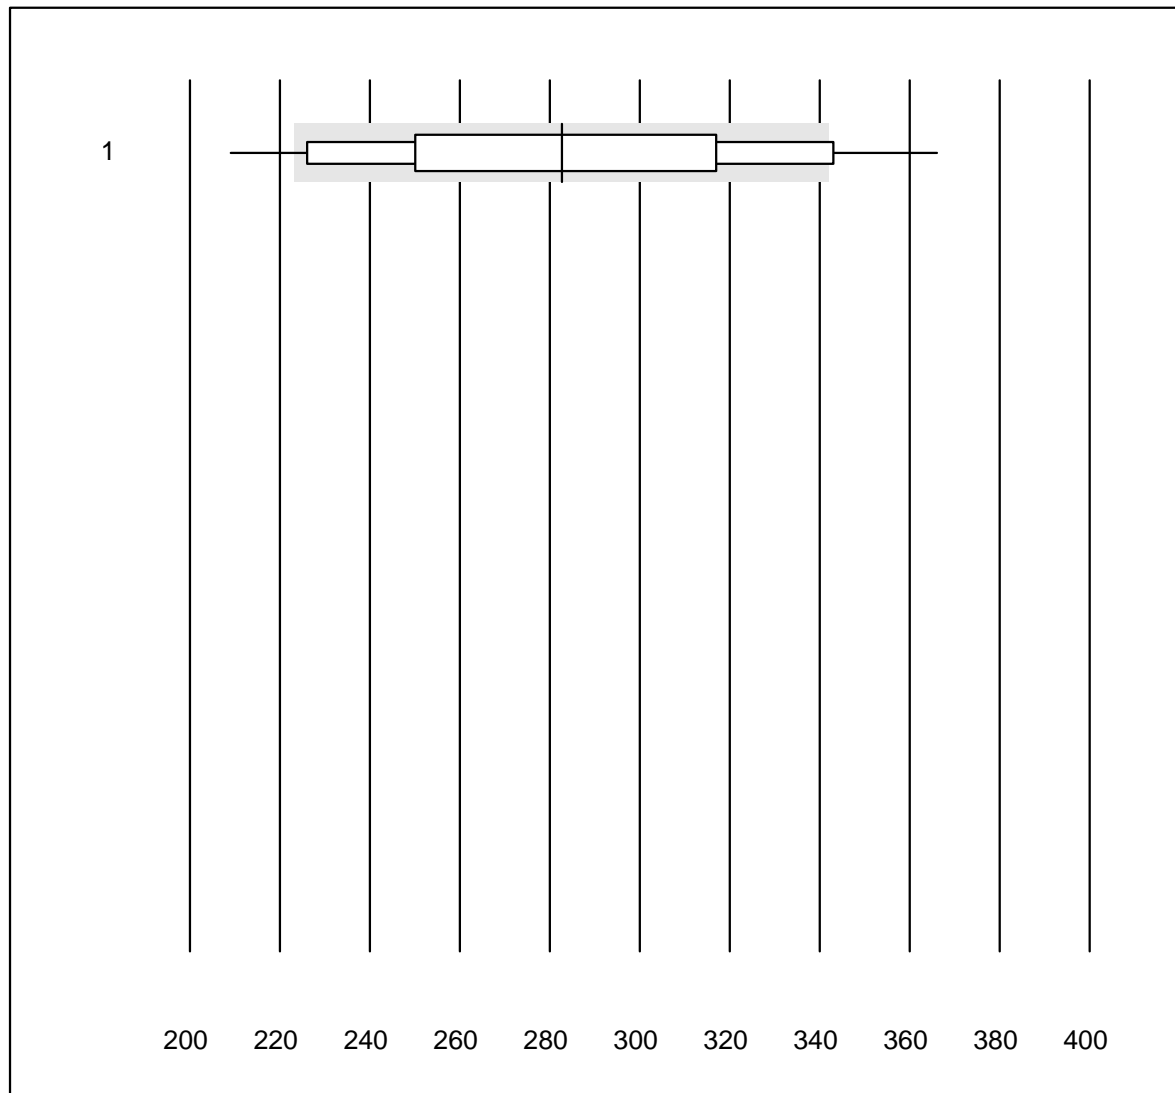


QUALAB Tolérance : 21 %

D-Dimere Triage (ng/ml)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Triage	37	75.7	18.9	5.4	282.63	15.4	e*

CK-MB Triage

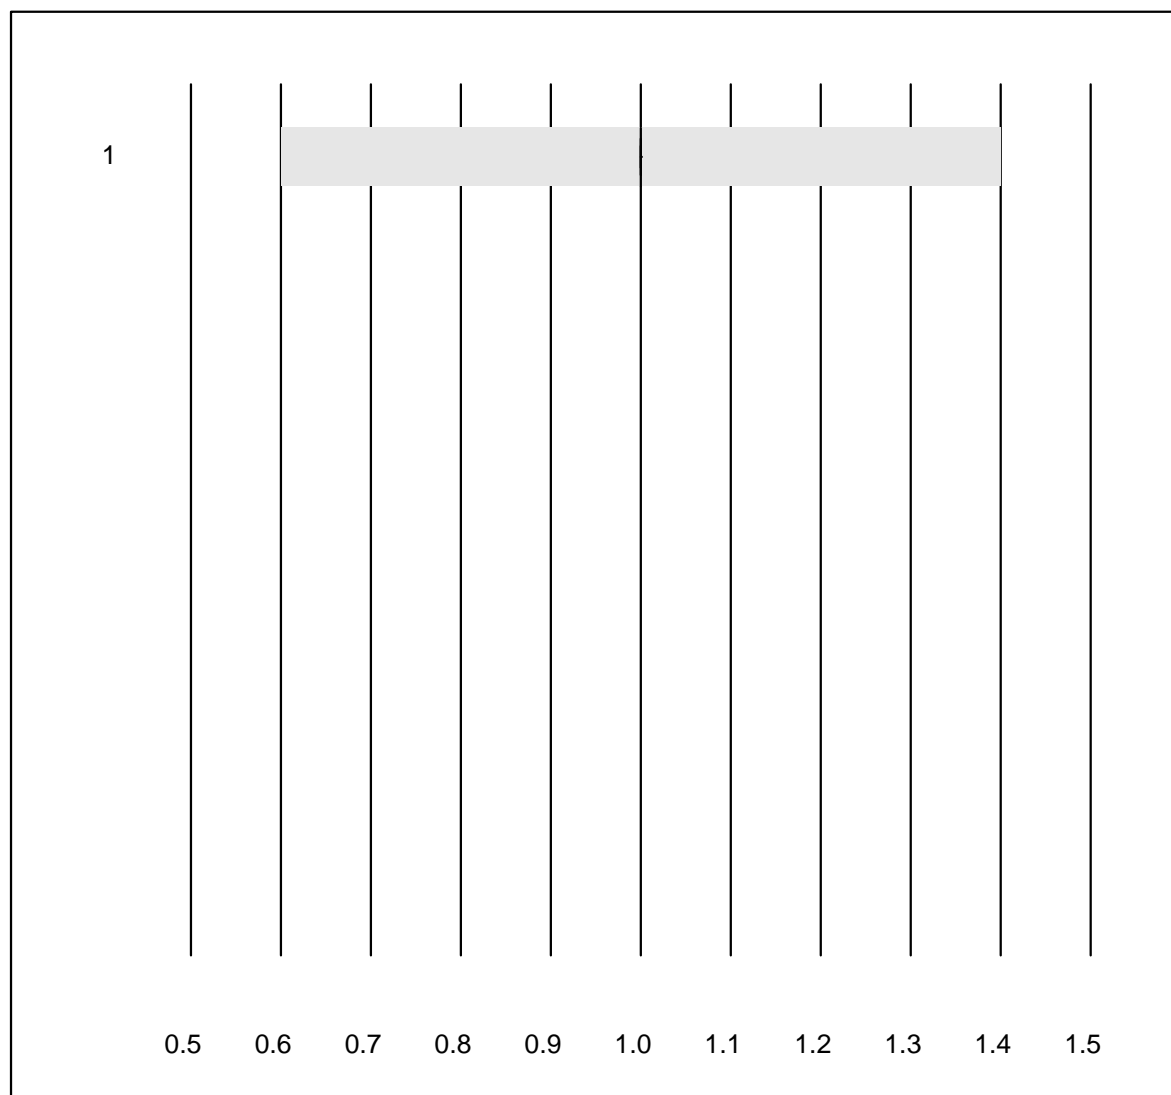


Tolérance MQ : 40 %

CK-MB Triage (µg/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Triage	5	80.0	0.0	20.0	1.0	0.0	e

Myoglobin Triage

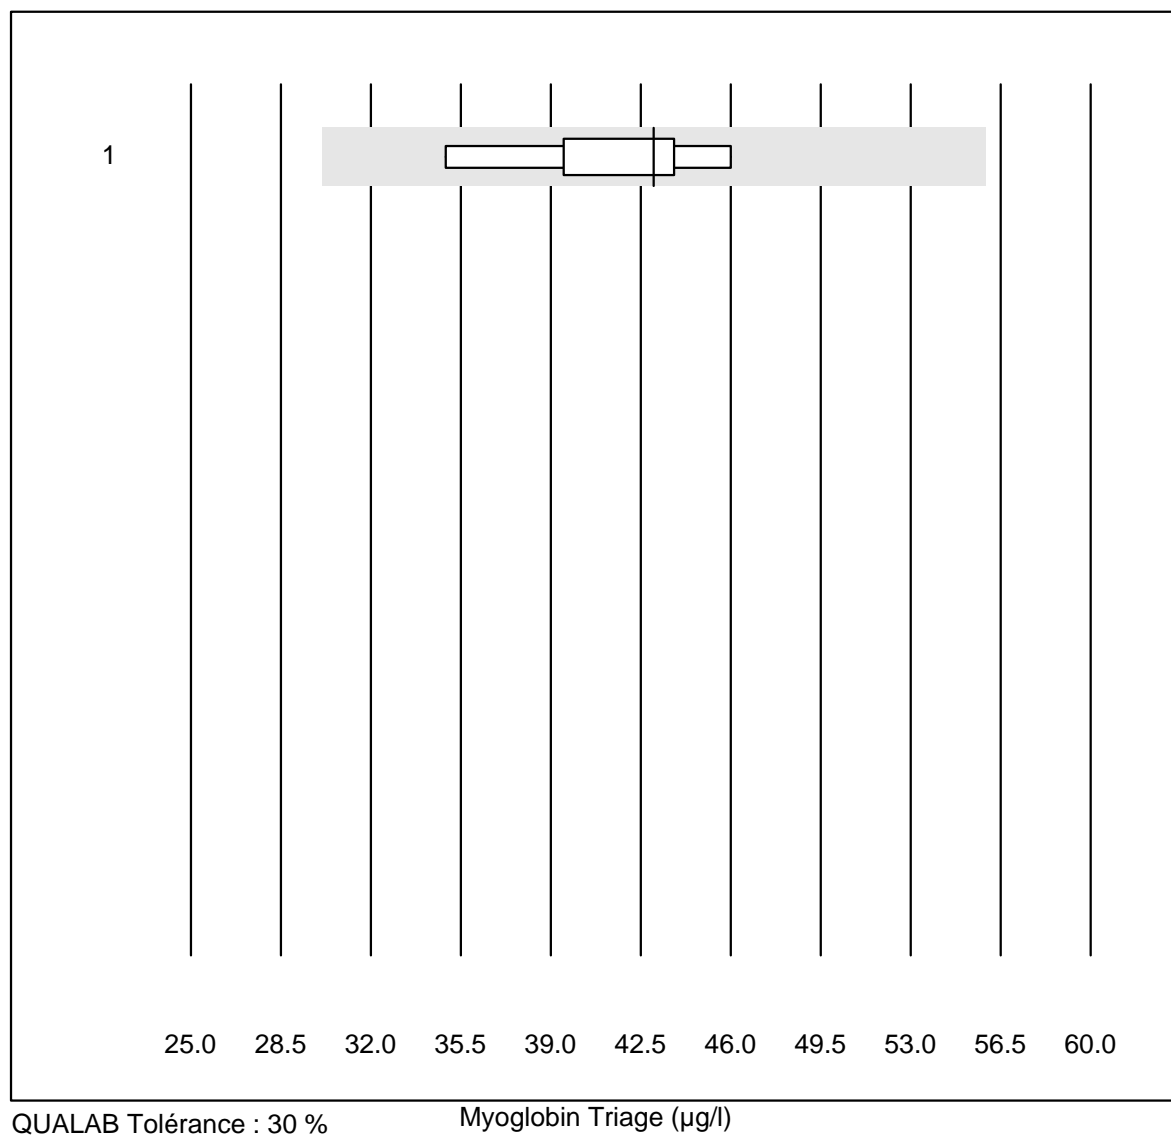

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Triage	5	100.0	0.0	0.0	43.0	10.5	e*

Vitamine D 25 (OH)

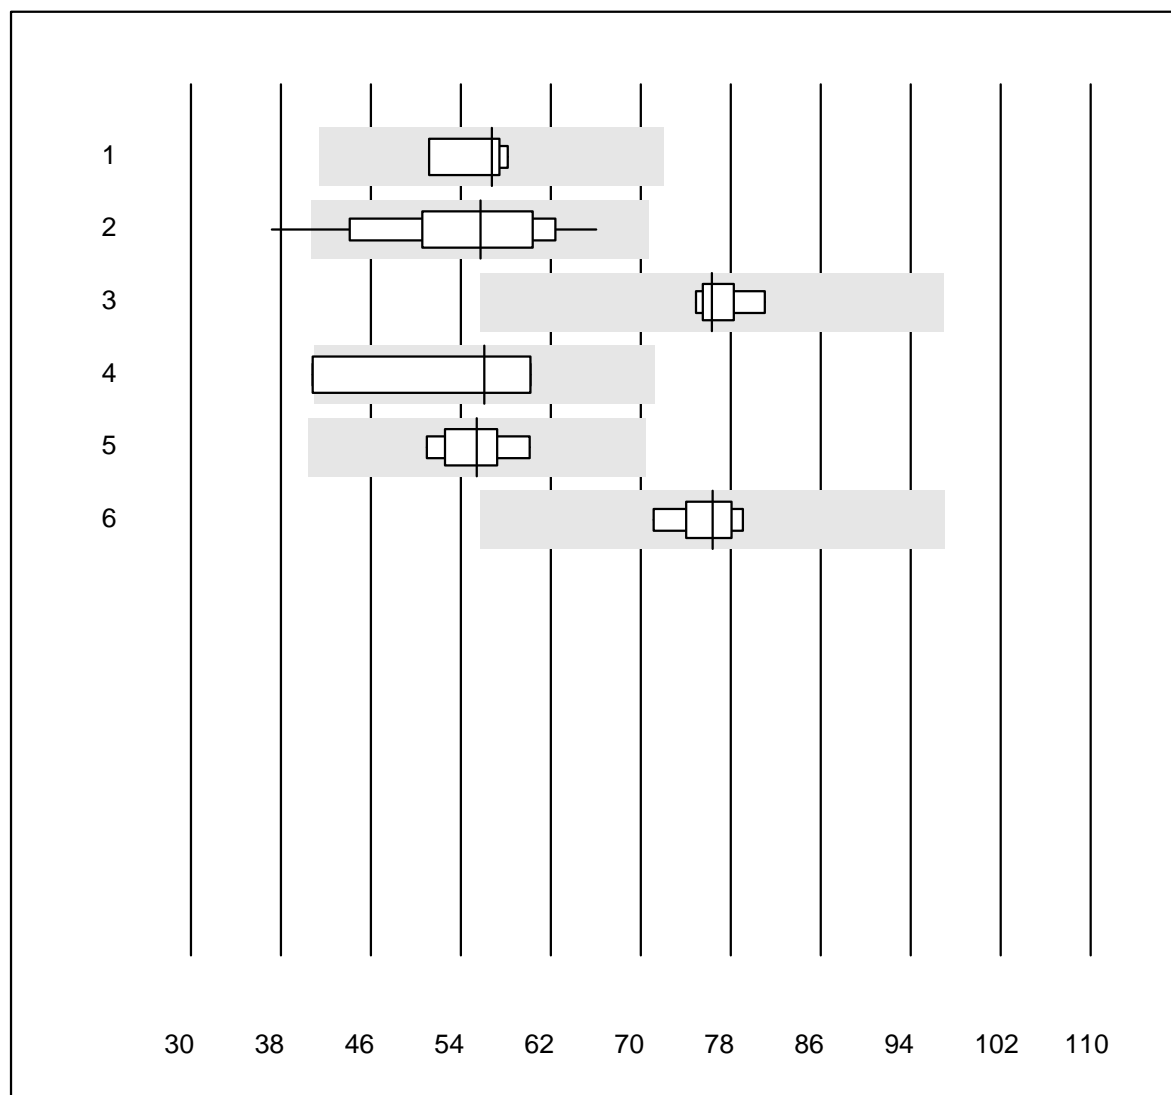


QUALAB Tolérance : 27 %

Vitamine D 25 (OH) (nmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 LCMS	4	100.0	0.0	0.0	56.8	5.6	e
2 Cobas	12	91.7	8.3	0.0	55.7	15.0	e*
3 VIDAS	6	100.0	0.0	0.0	76.3	2.9	e
4 Autres méthodes	4	50.0	25.0	25.0	56.1	19.2	a
5 Architect	9	100.0	0.0	0.0	55.4	5.9	e
6 Beckman	6	100.0	0.0	0.0	76.4	3.8	e

AMH

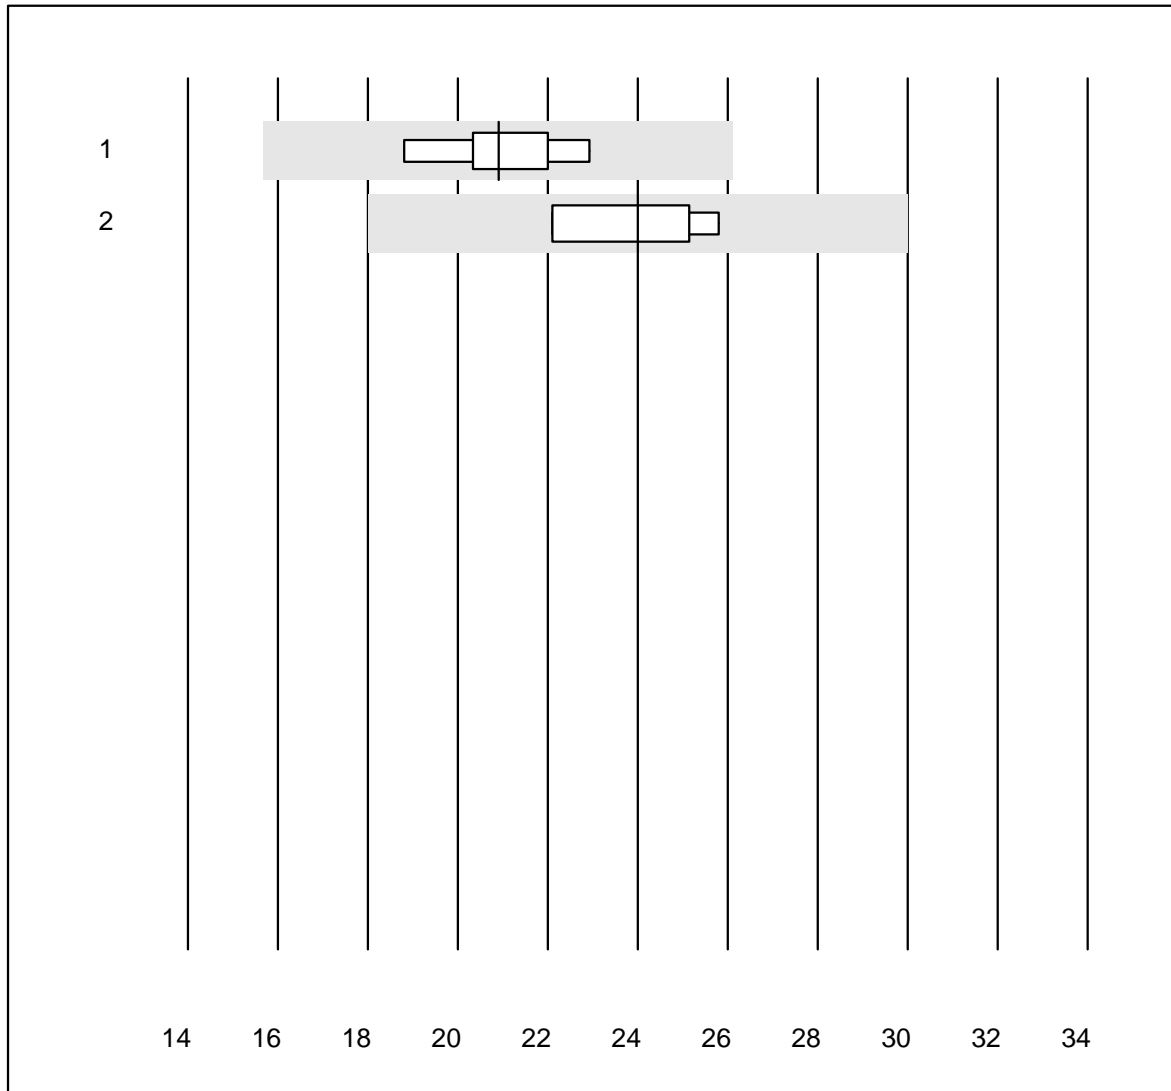


Tolérance MQ : 25 %

AMH (pmol/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	9	100.0	0.0	0.0	20.9	5.9	e
2 Beckman	4	100.0	0.0	0.0	24.0	7.4	e*

Calcitonin

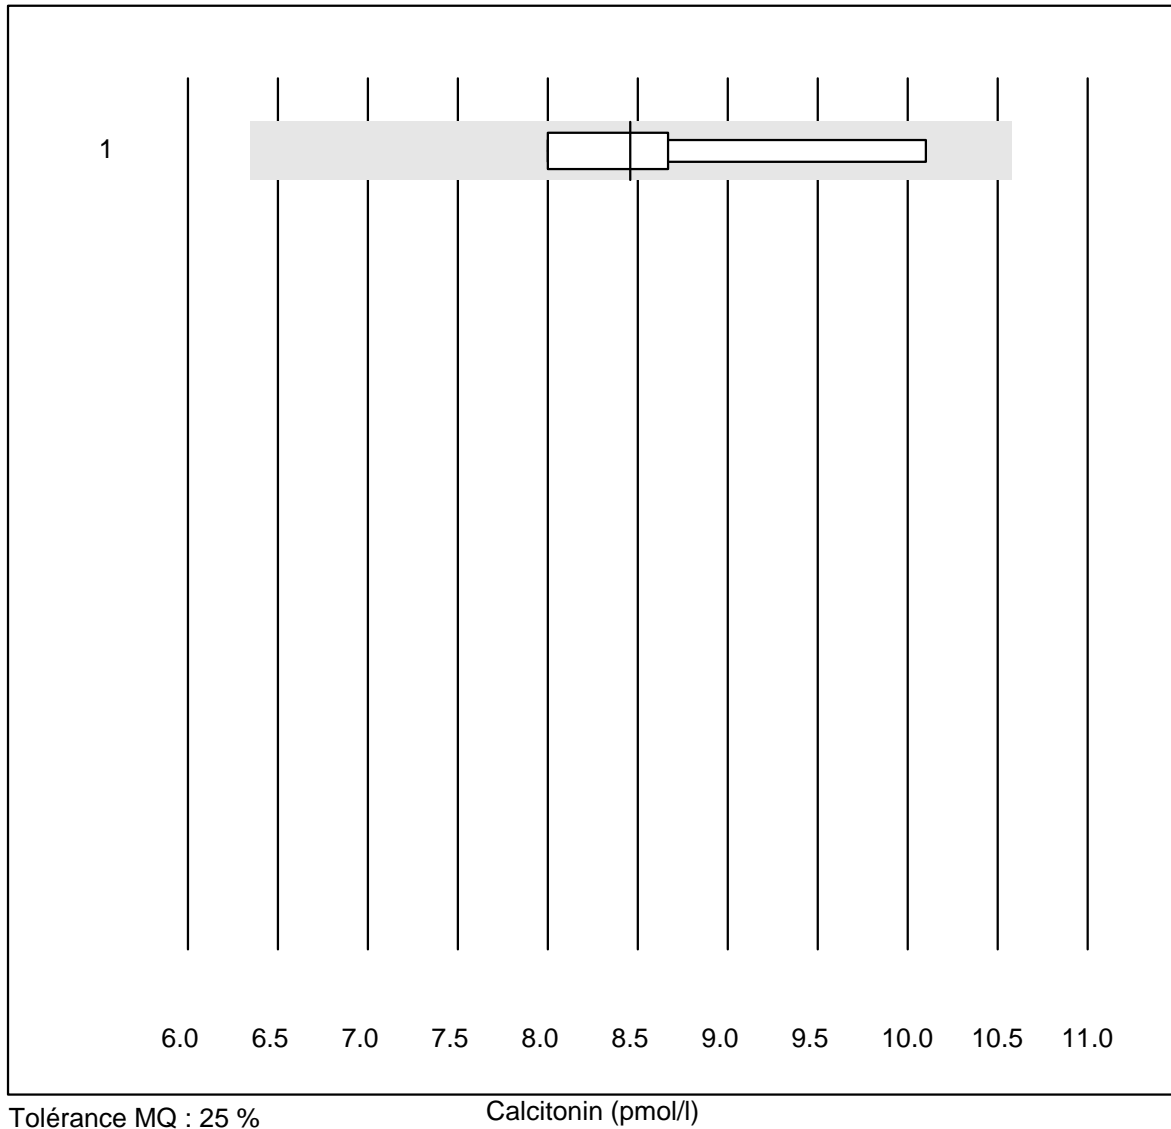


No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	8.5	10.7	e*

Renin

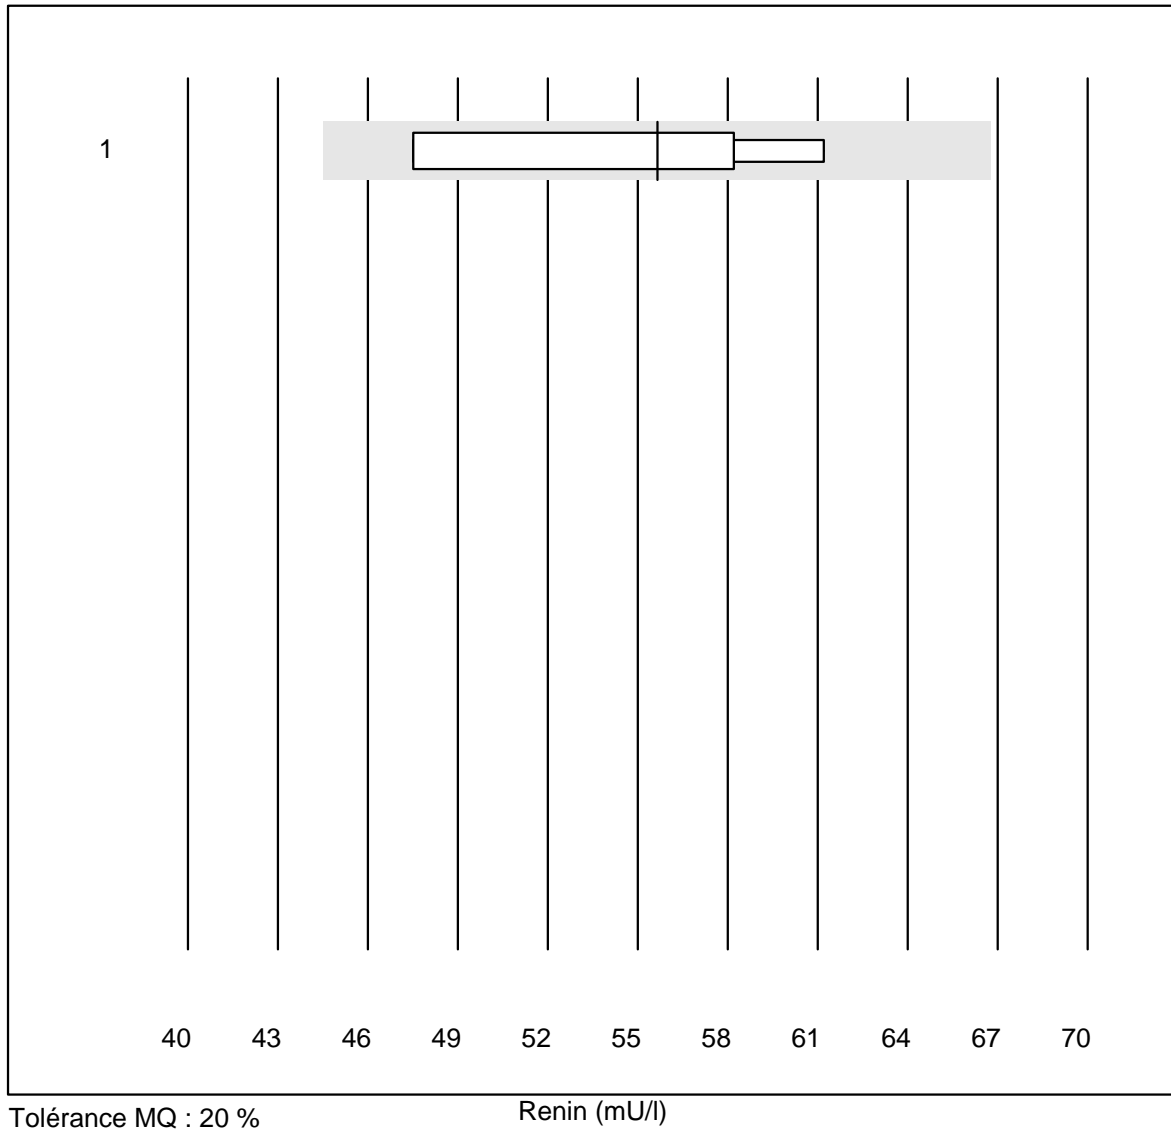

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Liaison	4	100.0	0.0	0.0	55.7	10.9	e*

Anti Thyreoglobulin

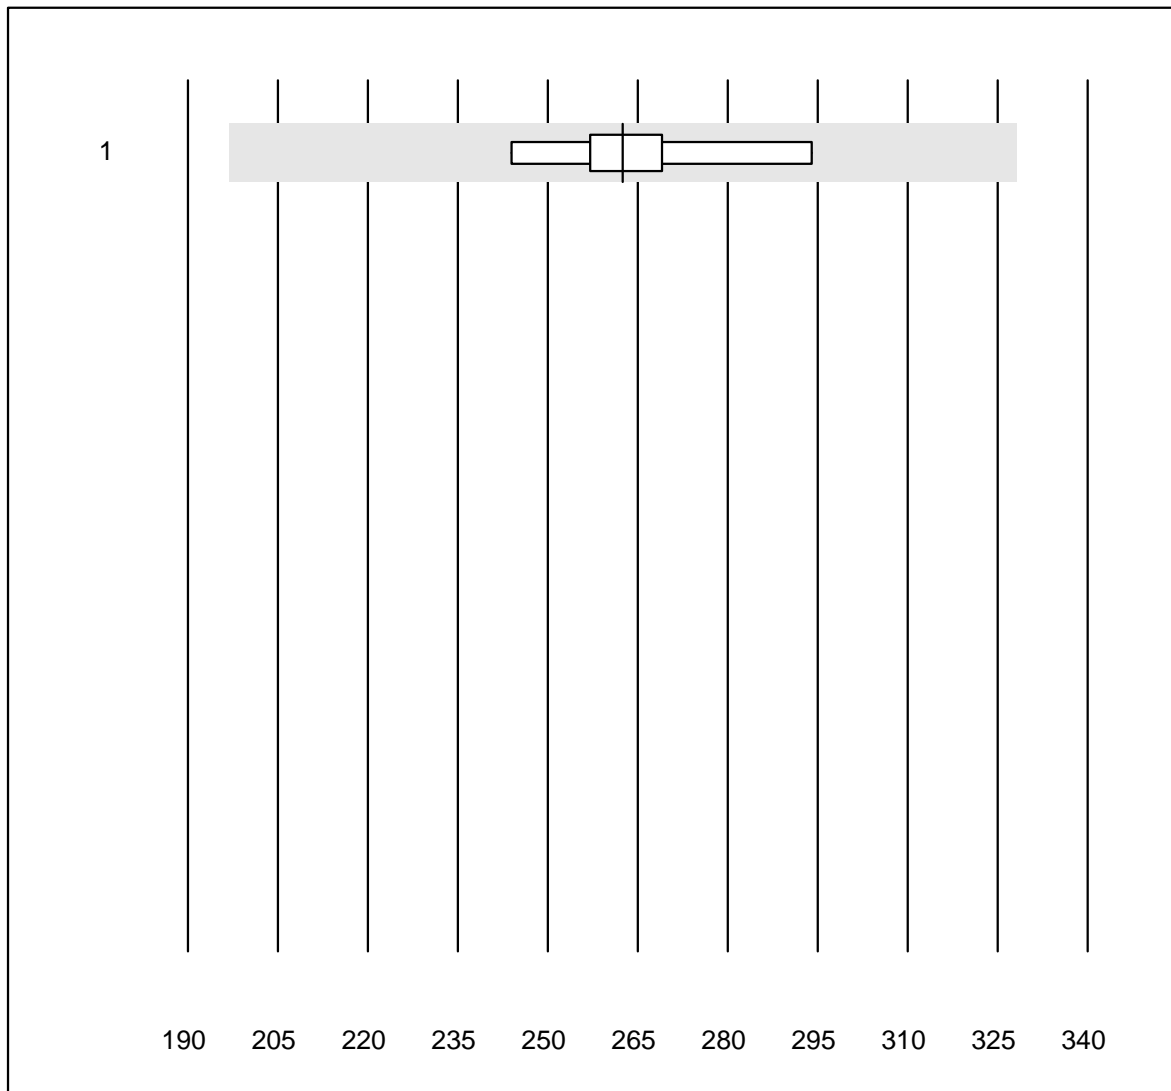


Tolérance MQ : 25 %

Anti Thyreoglobulin (IU/ml)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	8	100.0	0.0	0.0	263	5.4	e

Anti TPO

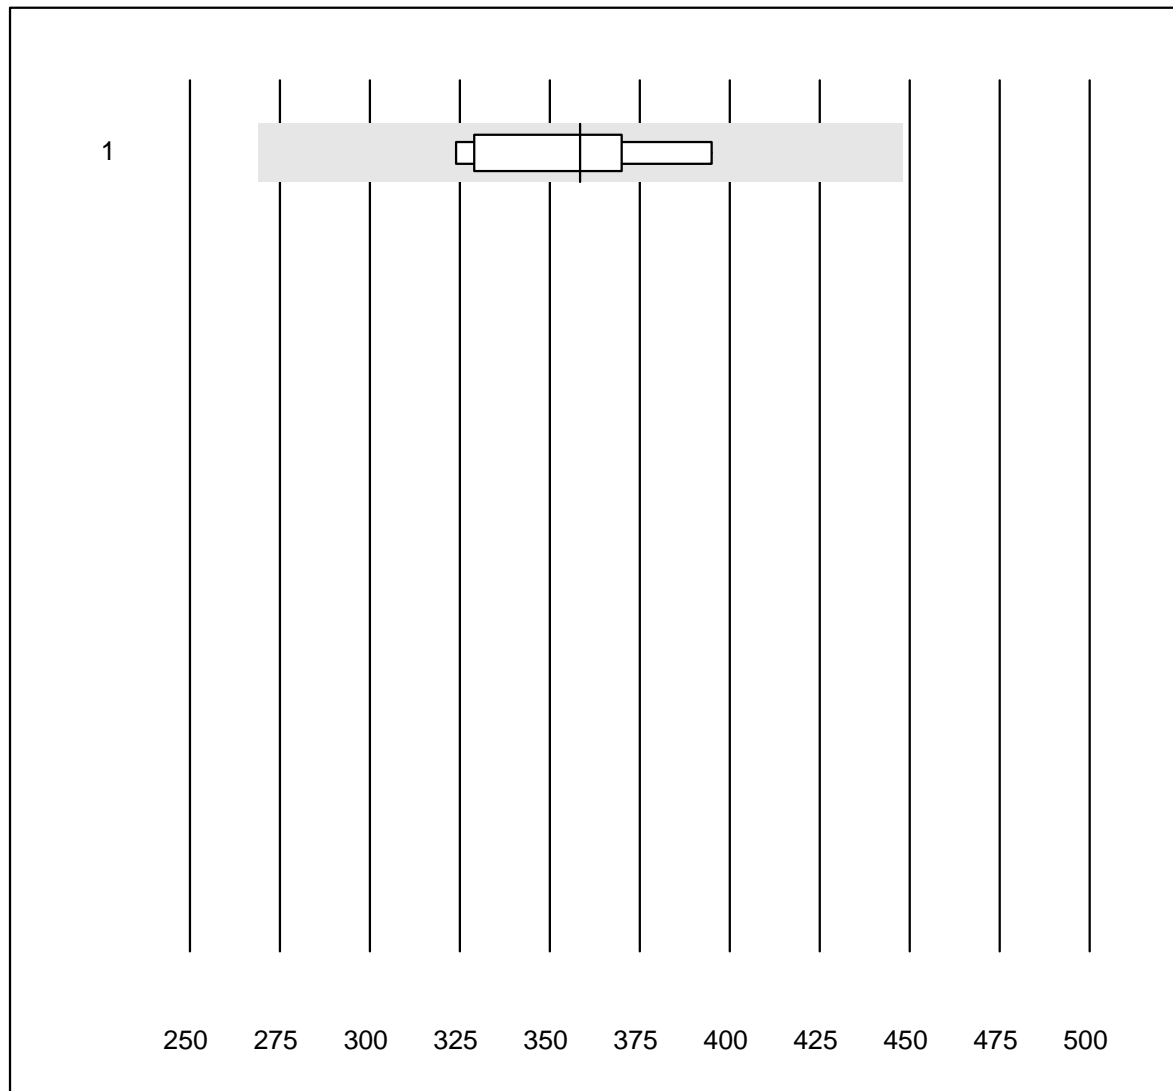


QUALAB Tolérance : 25 %

Anti TPO (IU/ml)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	8	100.0	0.0	0.0	359	7.4	e

TRAK

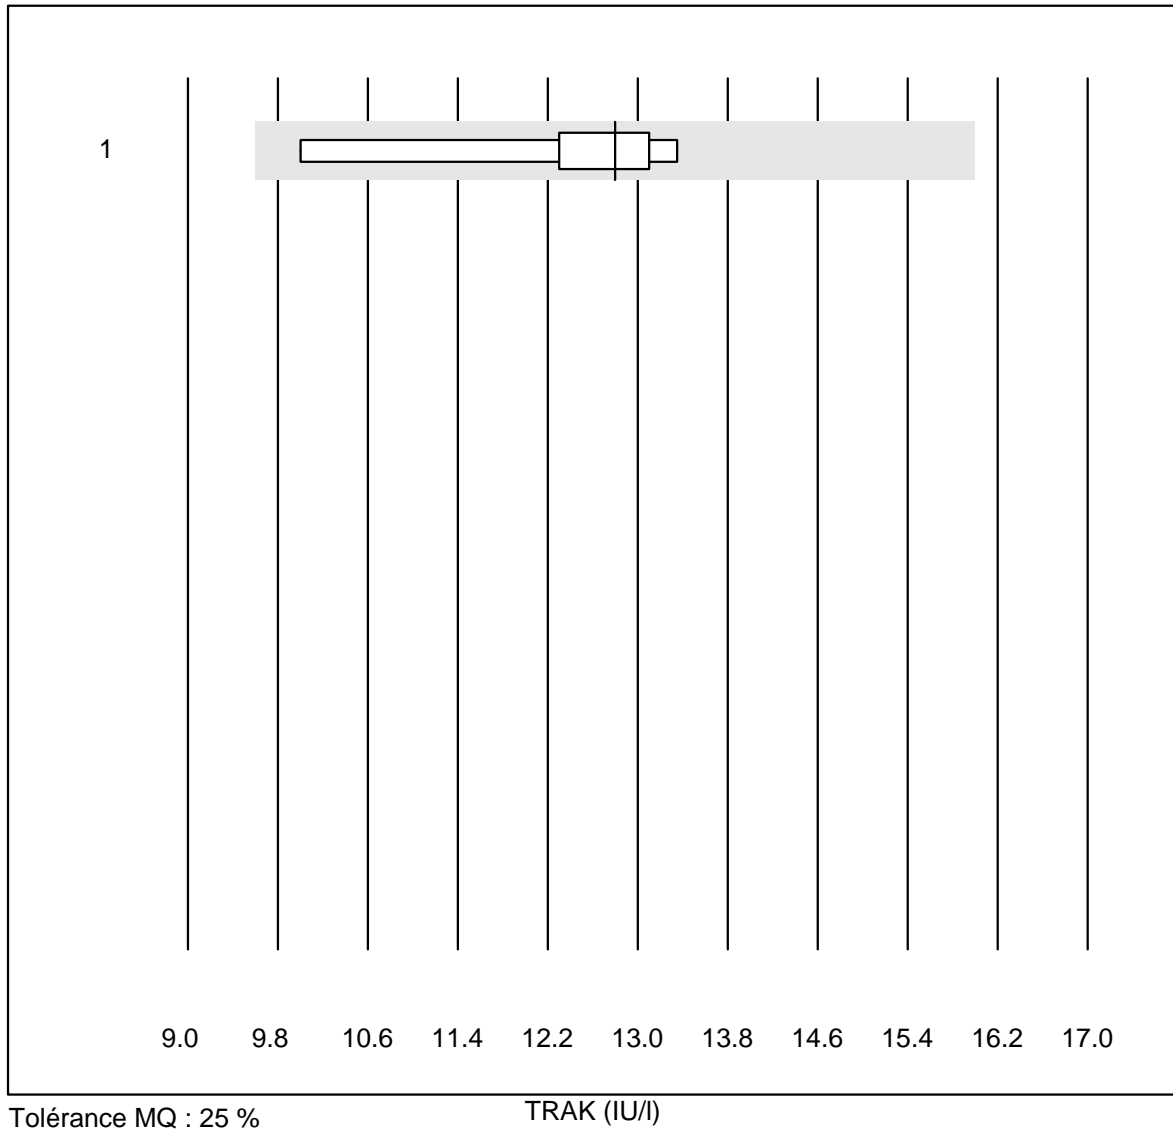

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	7	100.0	0.0	0.0	12.80	9.1	e*

Créatinine WB

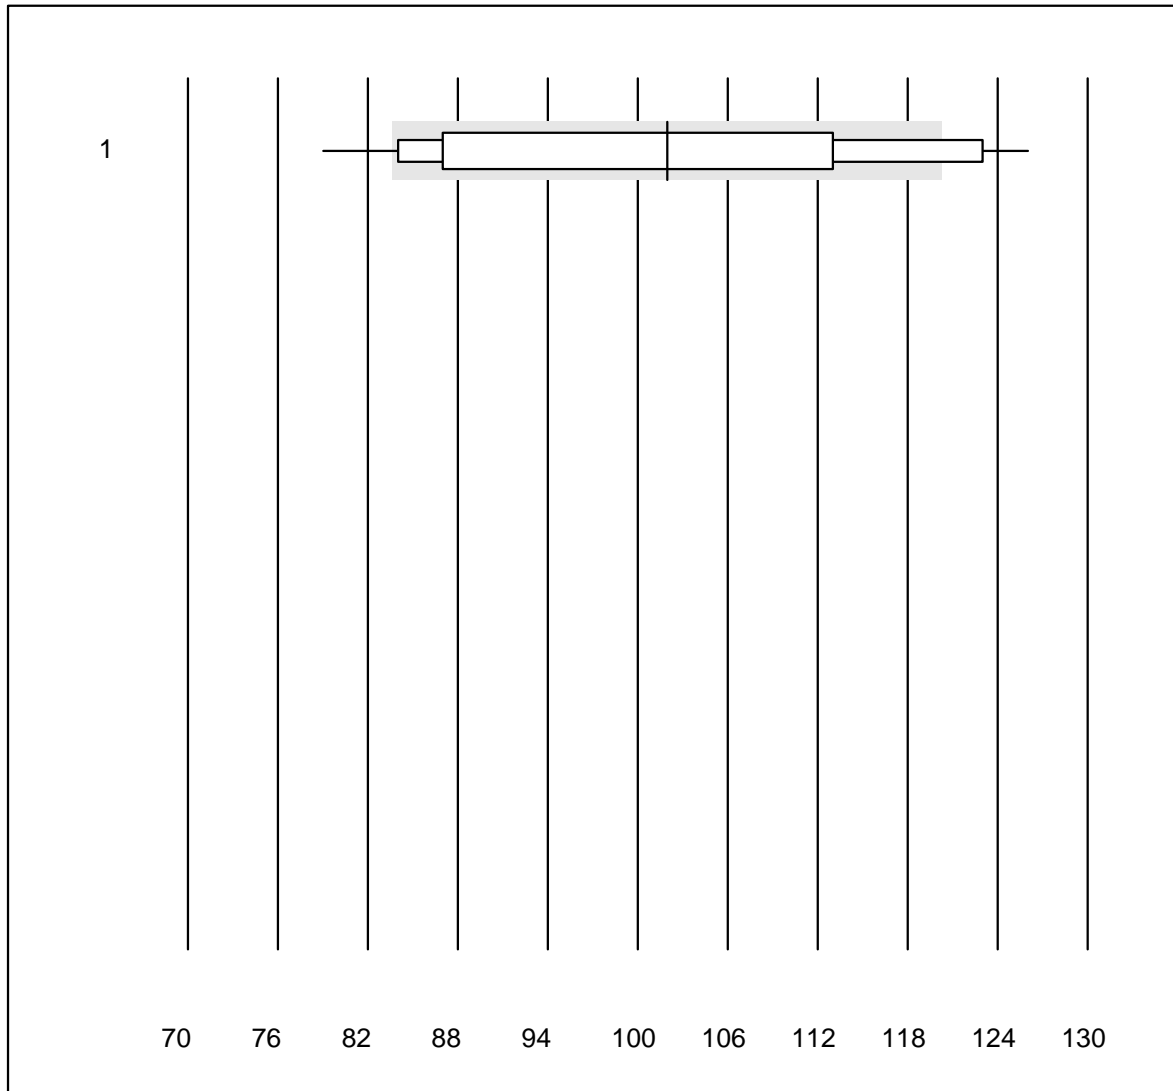


QUALAB Tolérance : 18 %

Créatinine WB ($\mu\text{mol/l}$)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Statsensor i / Nova	46	69.5	19.6	10.9	102	14.1	e

IL6

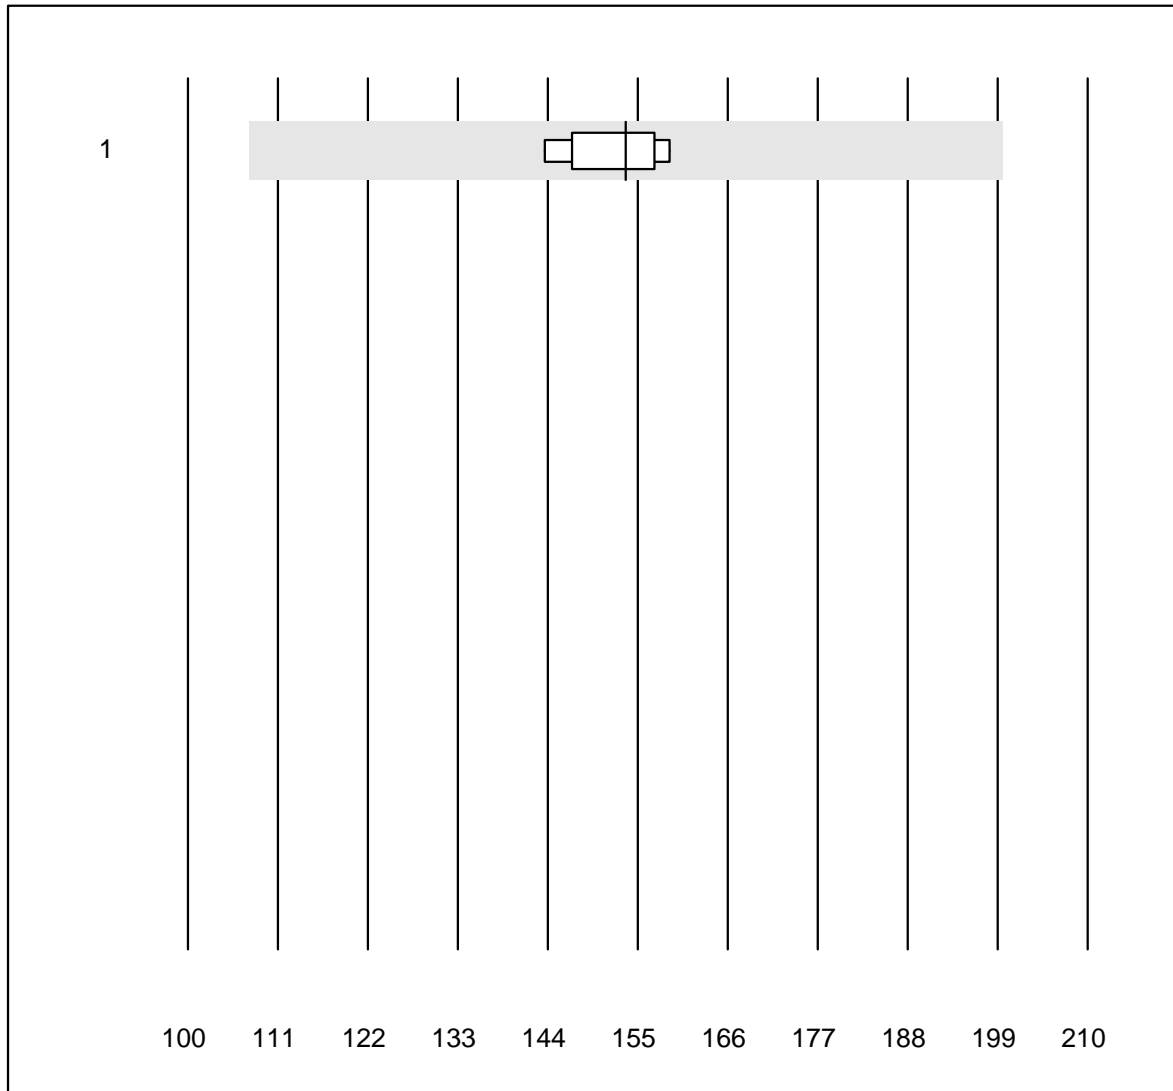


Tolérance MQ : 30 %

IL6 (ng/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	153.5	4.3	e

Calcium-urine

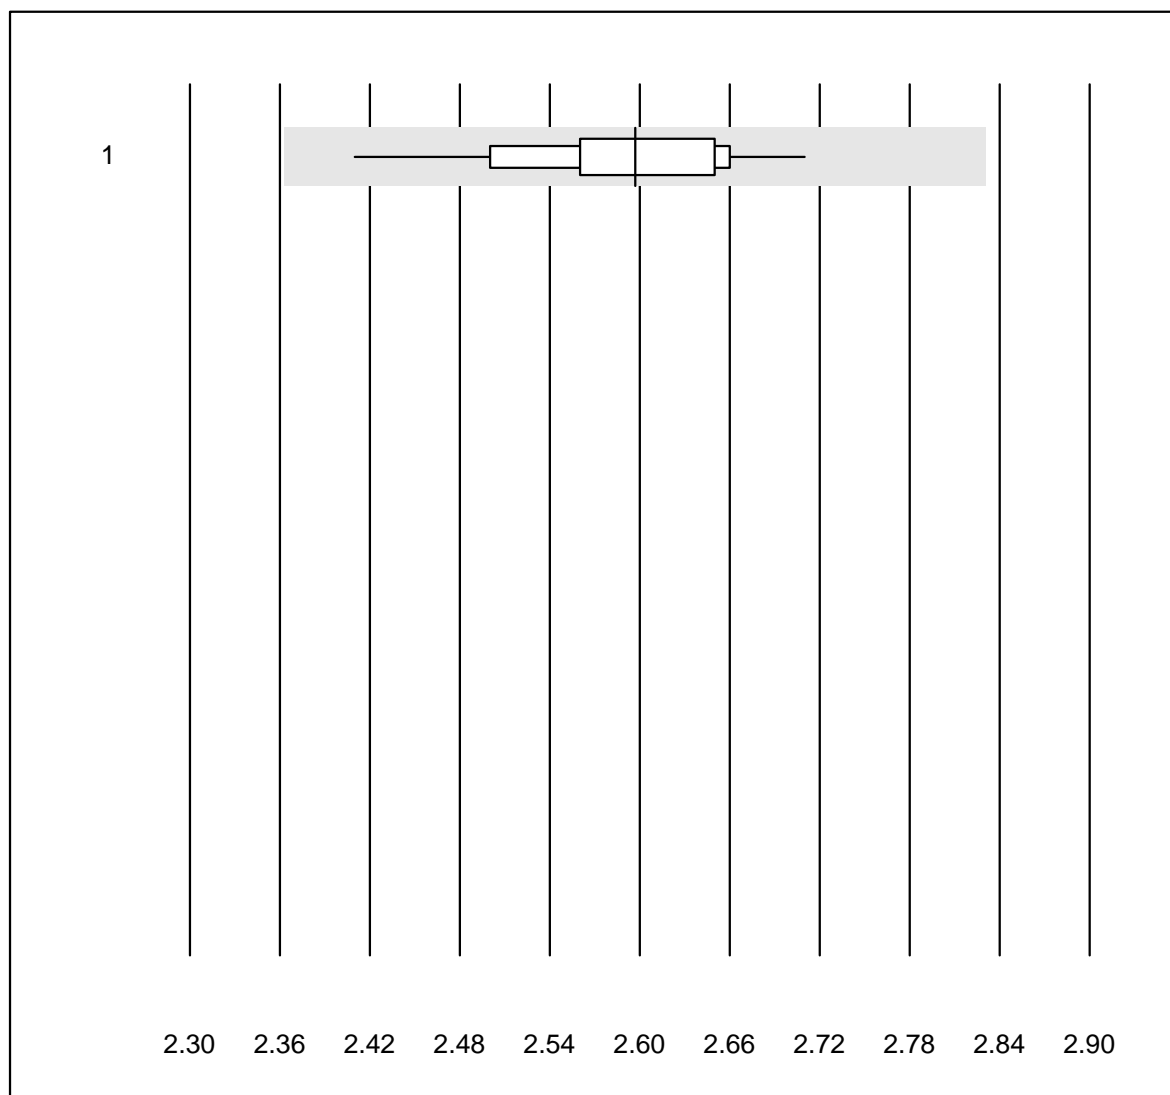


Tolérance MQ : 9 %

Calcium-urine (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	20	100.0	0.0	0.0	2.60	2.8	e

Chlorures-urine

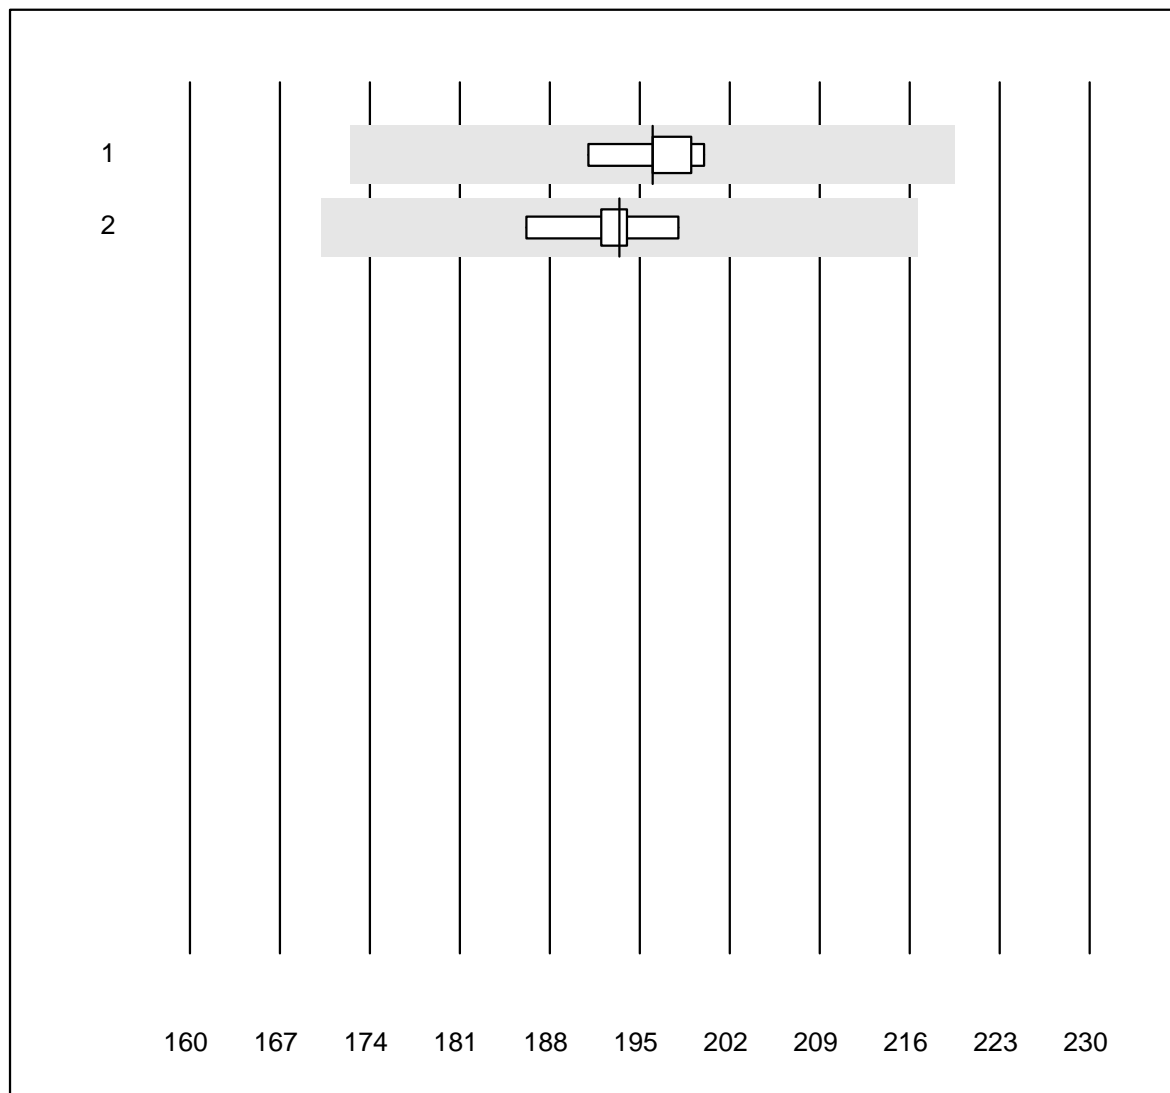


Tolérance MQ : 12 %

Chlorures-urine (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	6	100.0	0.0	0.0	196	1.6	e
2 Cobas	9	100.0	0.0	0.0	193	1.9	e

Glucose-urine

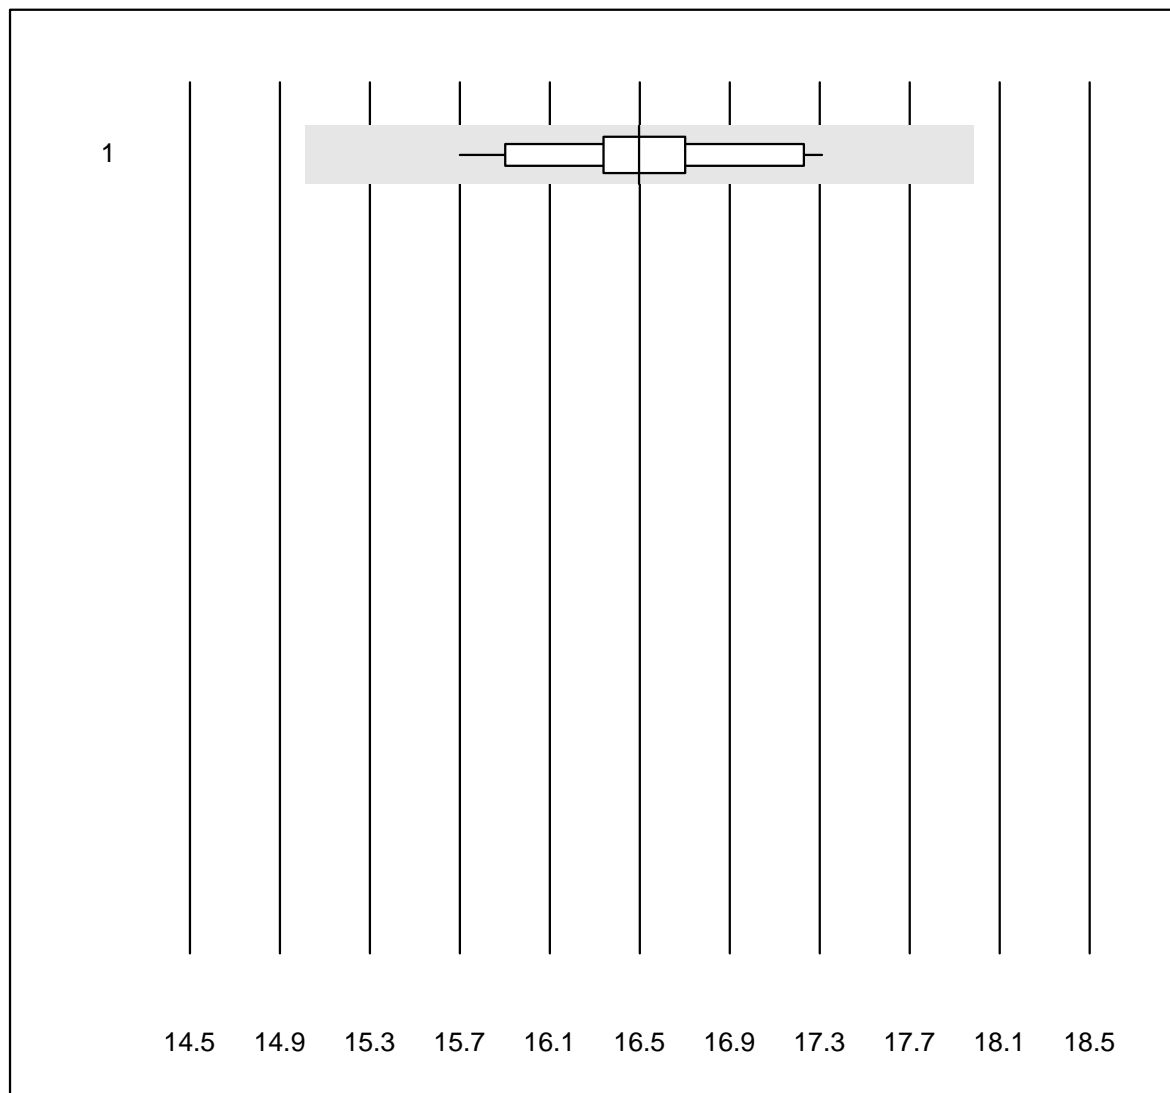


QUALAB Tolérance : 9 %

Glucose-urine (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	17	100.0	0.0	0.0	16.5	2.6	e

Magnésium-urine

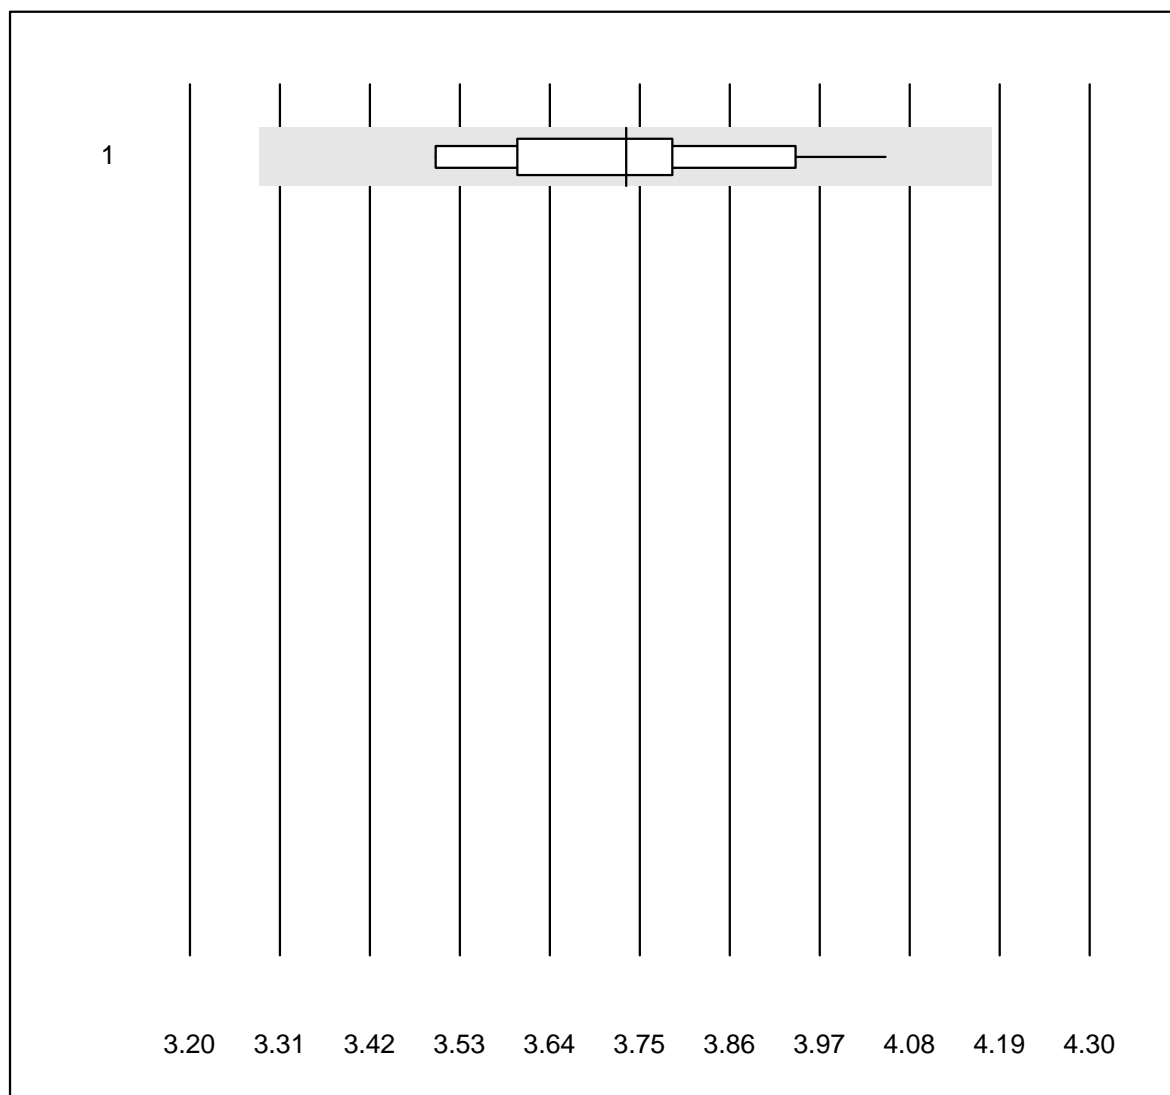


Tolérance MQ : 12 %

Magnésium-urine (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	10	100.0	0.0	0.0	3.73	4.5	e

Osmolalité-urine

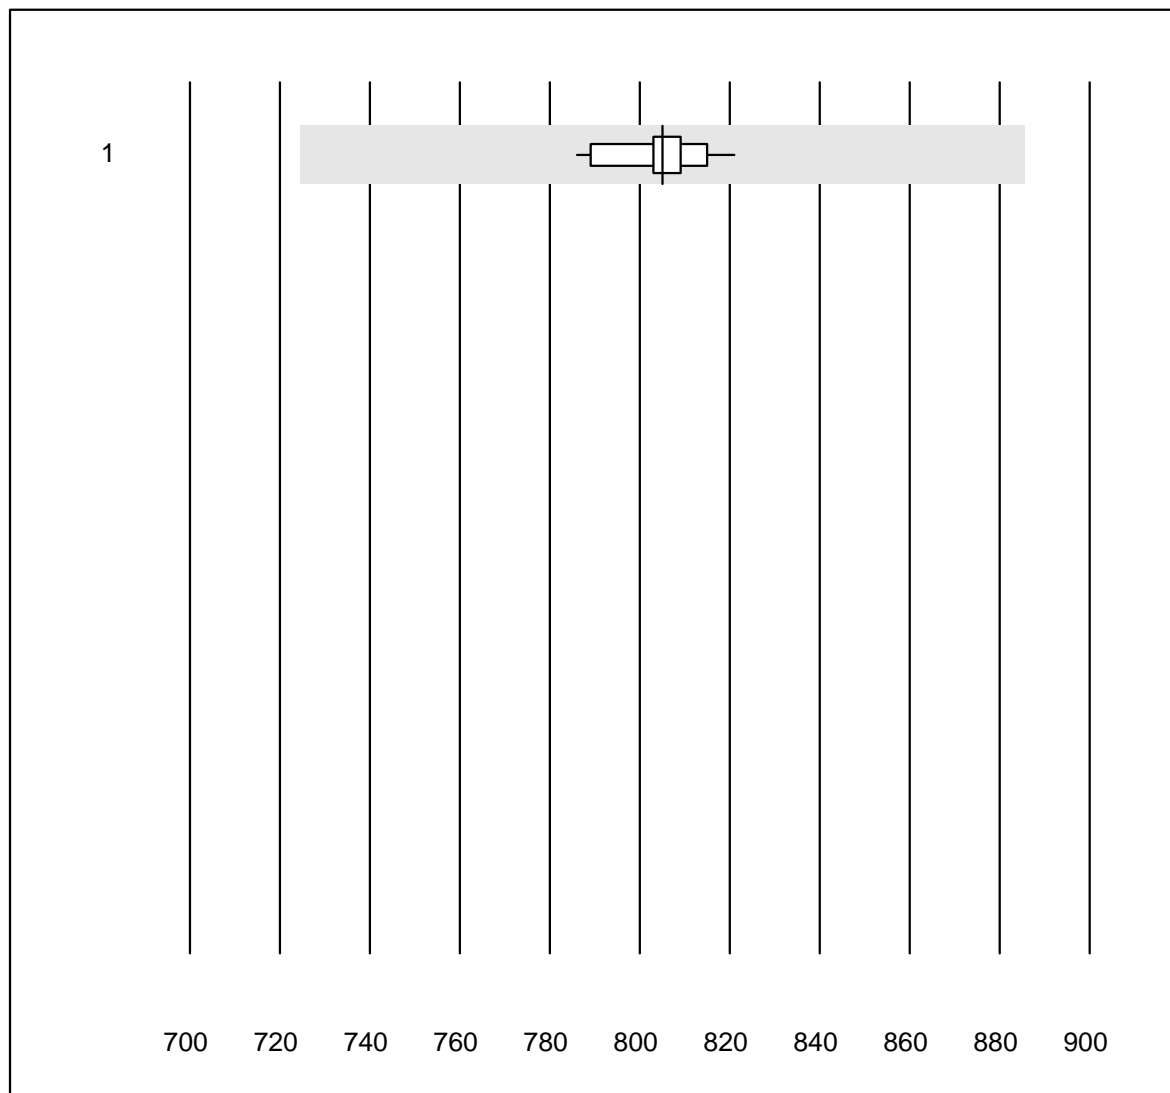


Tolérance MQ : 10 %

Osmolalité-urine (mosm/kg)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cryoscopie	15	100.0	0.0	0.0	805	1.1	e

Phosphore-urine

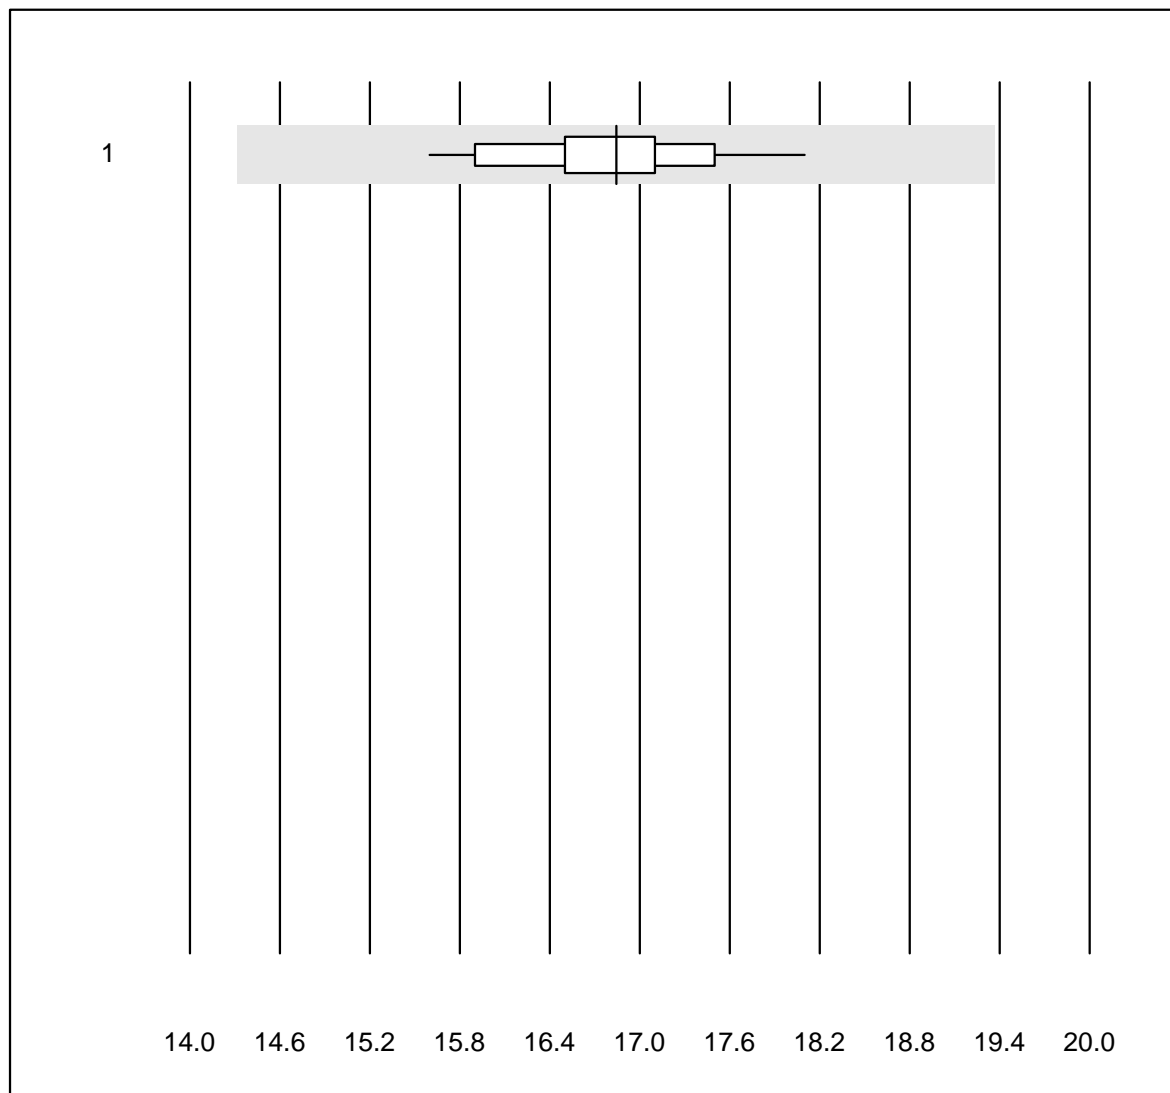


Tolérance MQ : 15 %

Phosphore-urine (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	16	100.0	0.0	0.0	16.8	3.6	e

Potassium-urine

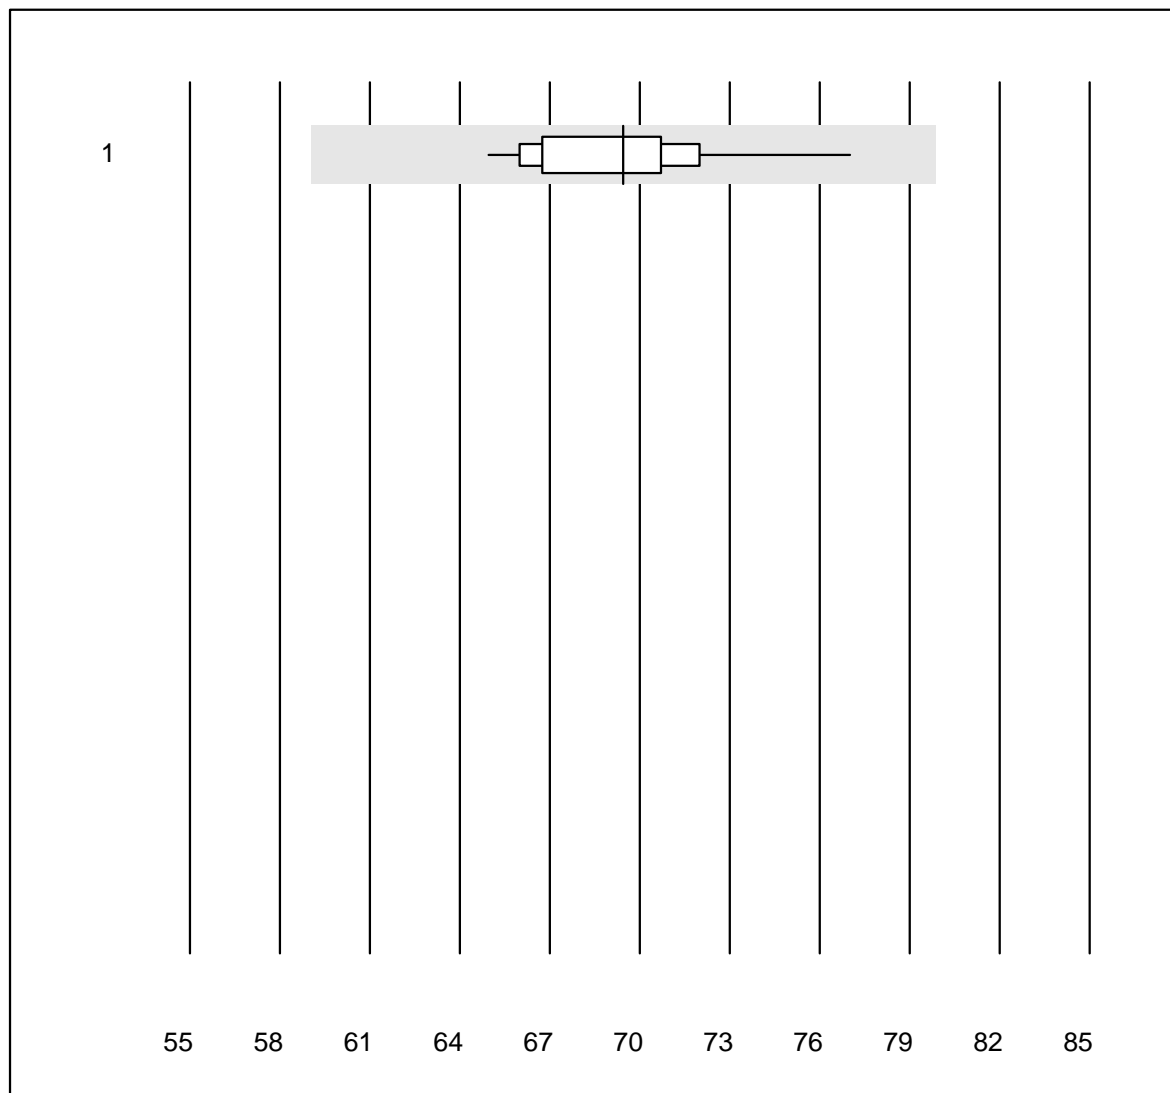


Tolérance MQ : 15 %

Potassium-urine (mmol/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	26	100.0	0.0	0.0	69	3.8	e

Protéines-urine

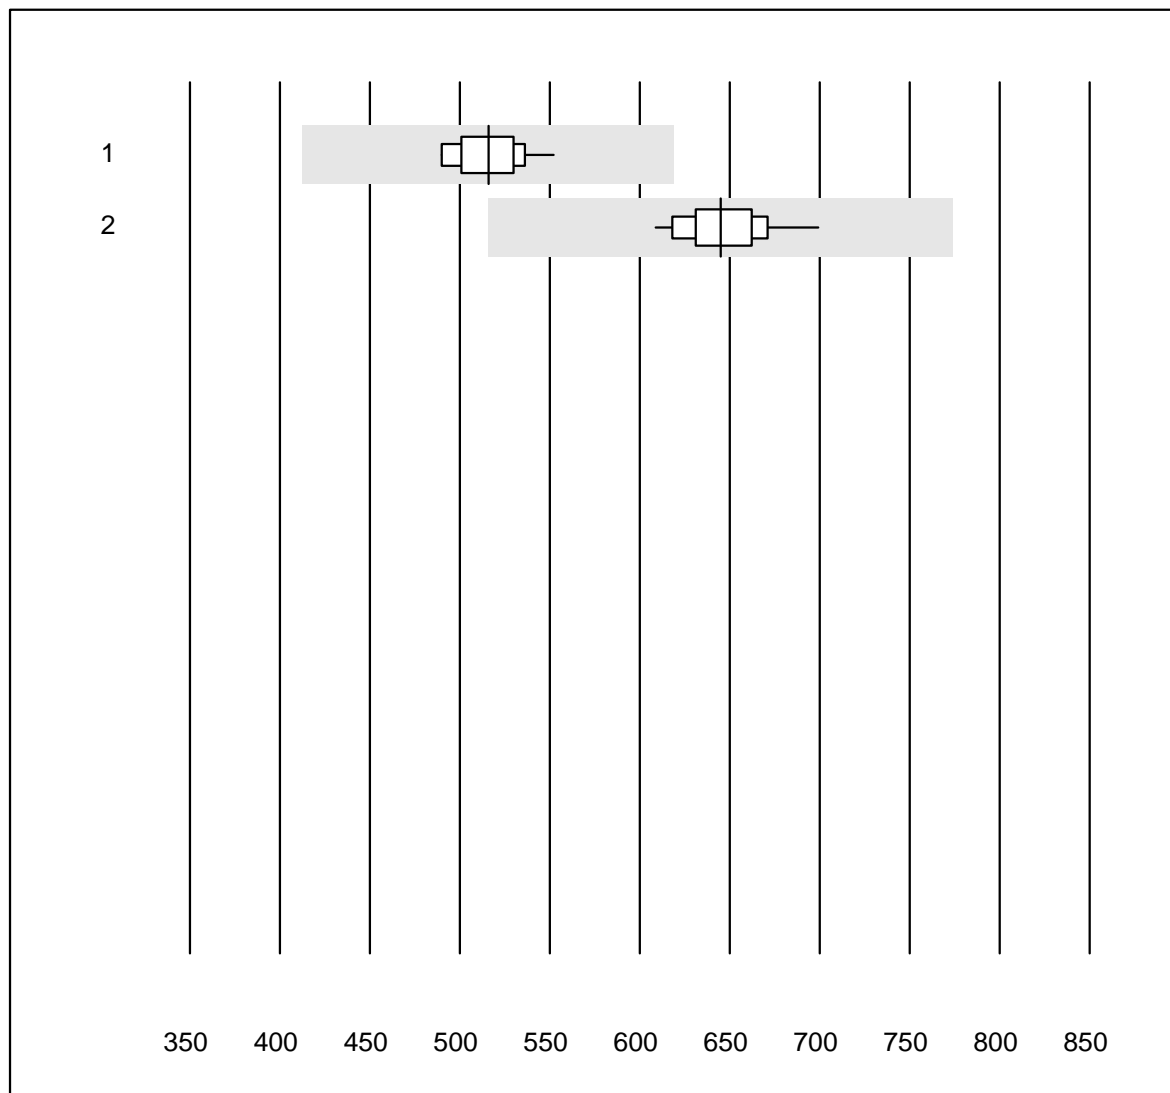


QUALAB Tolérance : 20 %

Protéines-urine (mg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas/Roche	15	100.0	0.0	0.0	515.8	3.4	e
2 Chimie humide	11	100.0	0.0	0.0	645.1	3.9	e

Sodium-urine

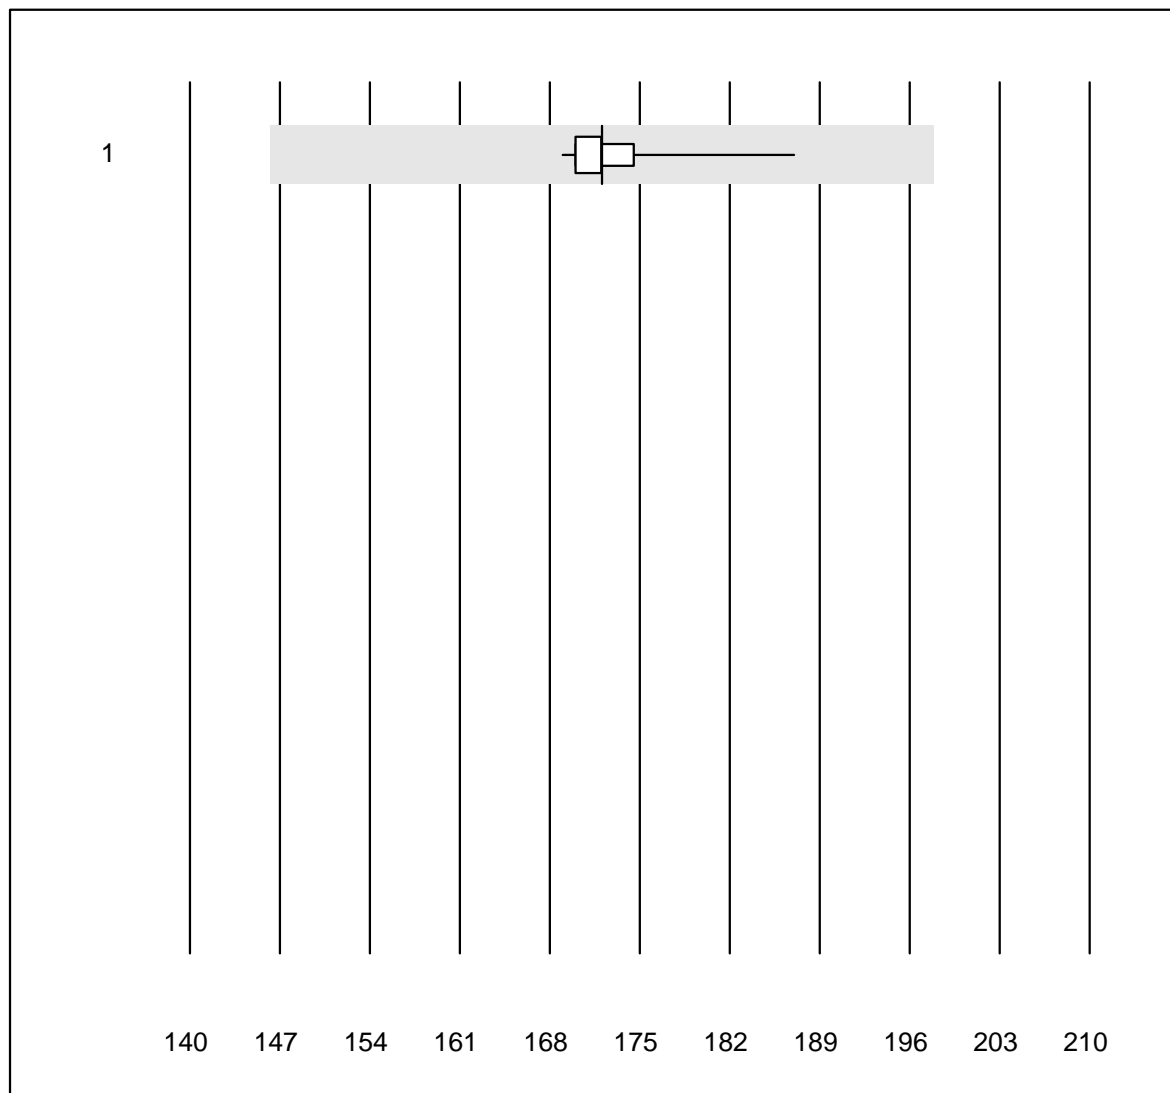

Tolérance MQ : 15 %

Sodium-urine (mmol/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	26	96.2	0.0	3.8	172	2.0	e

Urée-urine




Tolérance MQ : 15 %

Urée-urine (mmol/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	22	100.0	0.0	0.0	253	4.3	e

Acide urique-urine

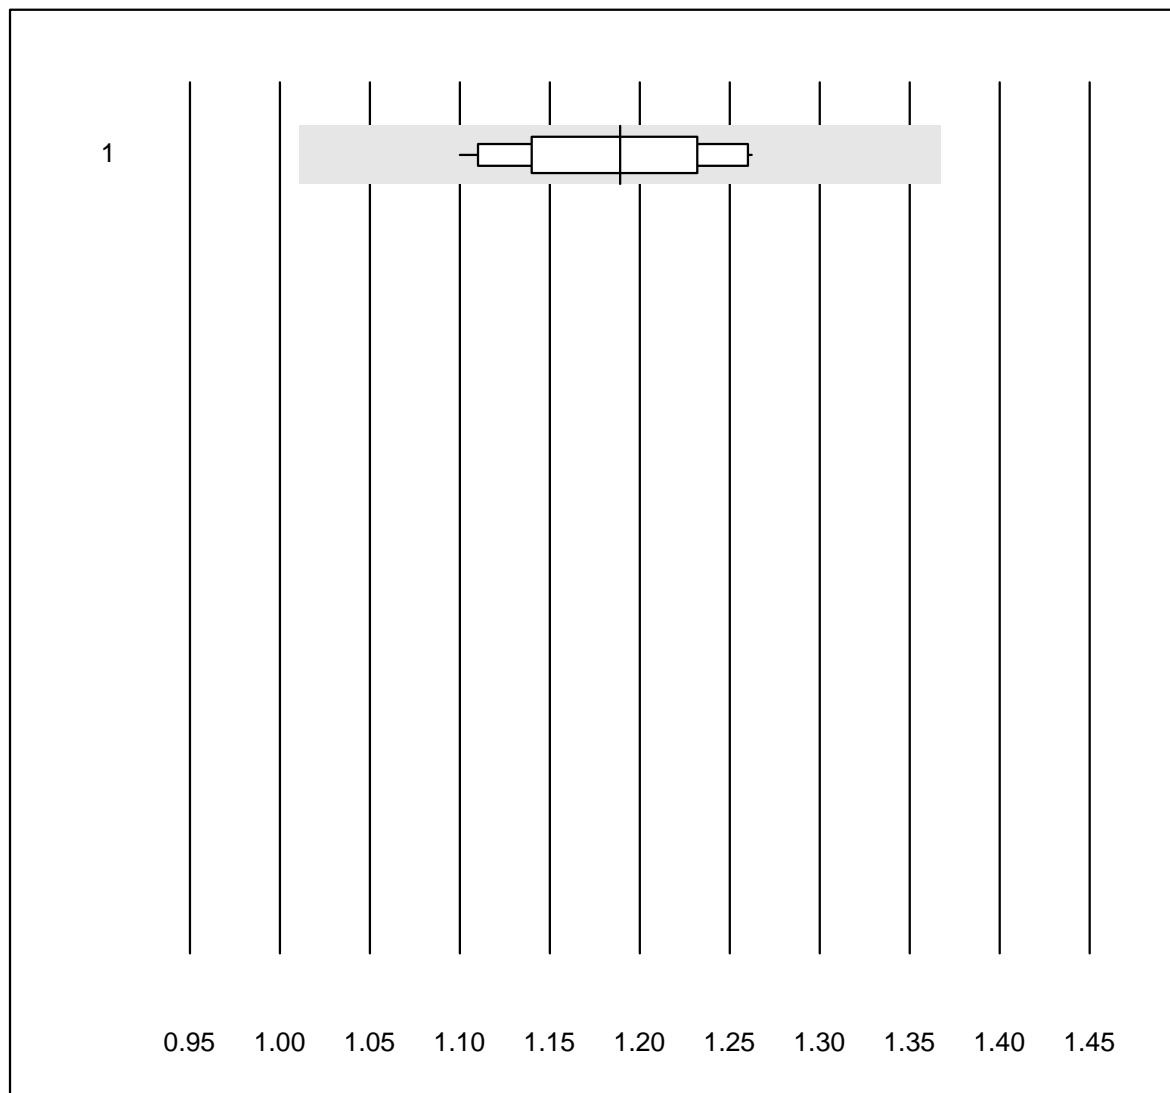


Tolérance MQ : 15 %

Acide urique-urine (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	16	100.0	0.0	0.0	1.19	4.5	e

Gravité spécifique-urine

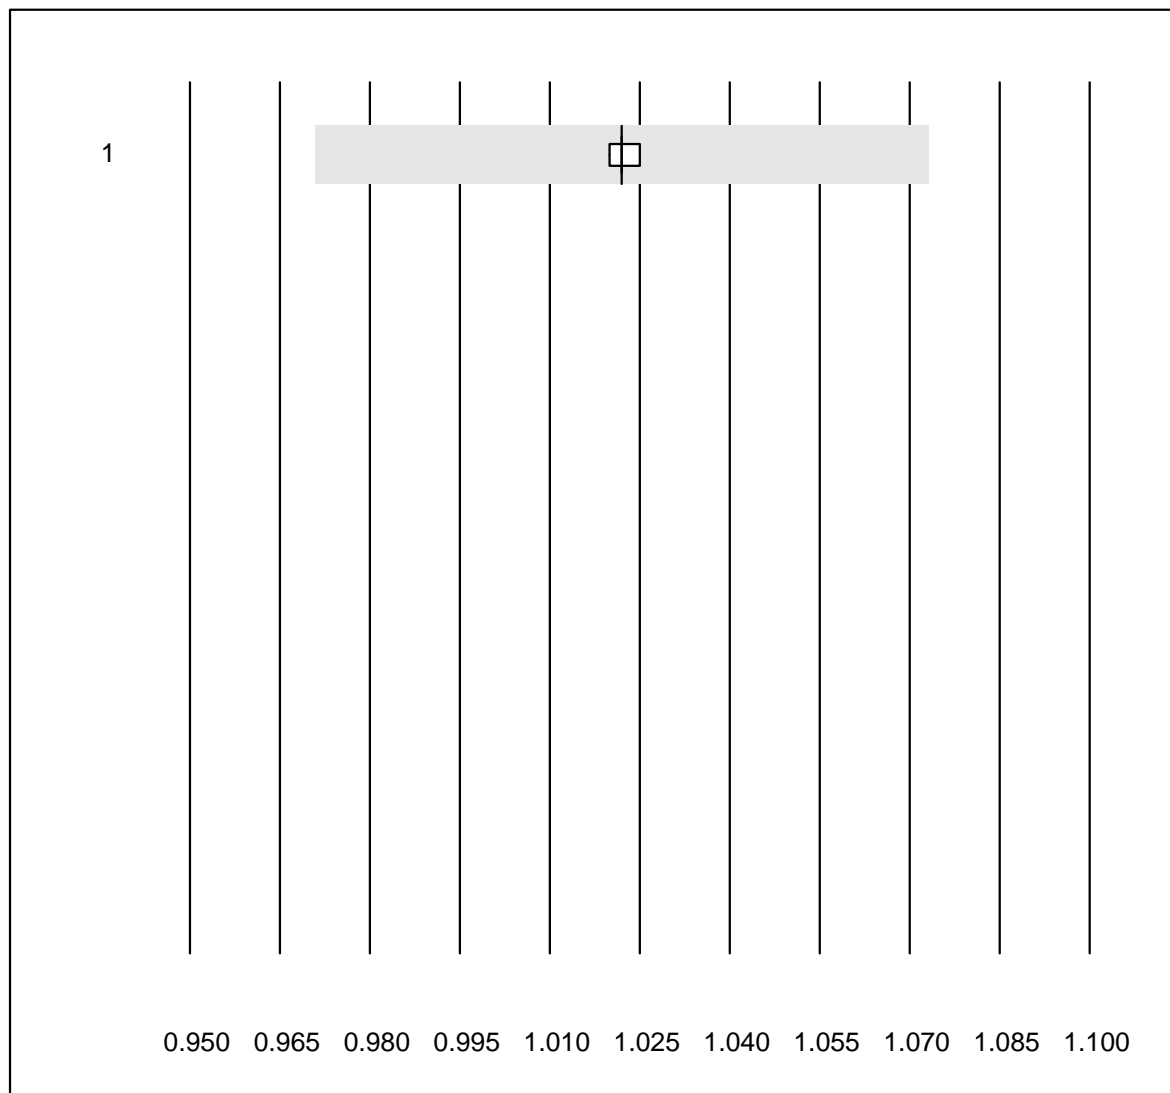


Tolérance MQ : 5 %

Gravité spécifique-urine ()

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Refraktometer	5	100.0	0.0	0.0	1.022	0.2	e

Ethylglucuronid

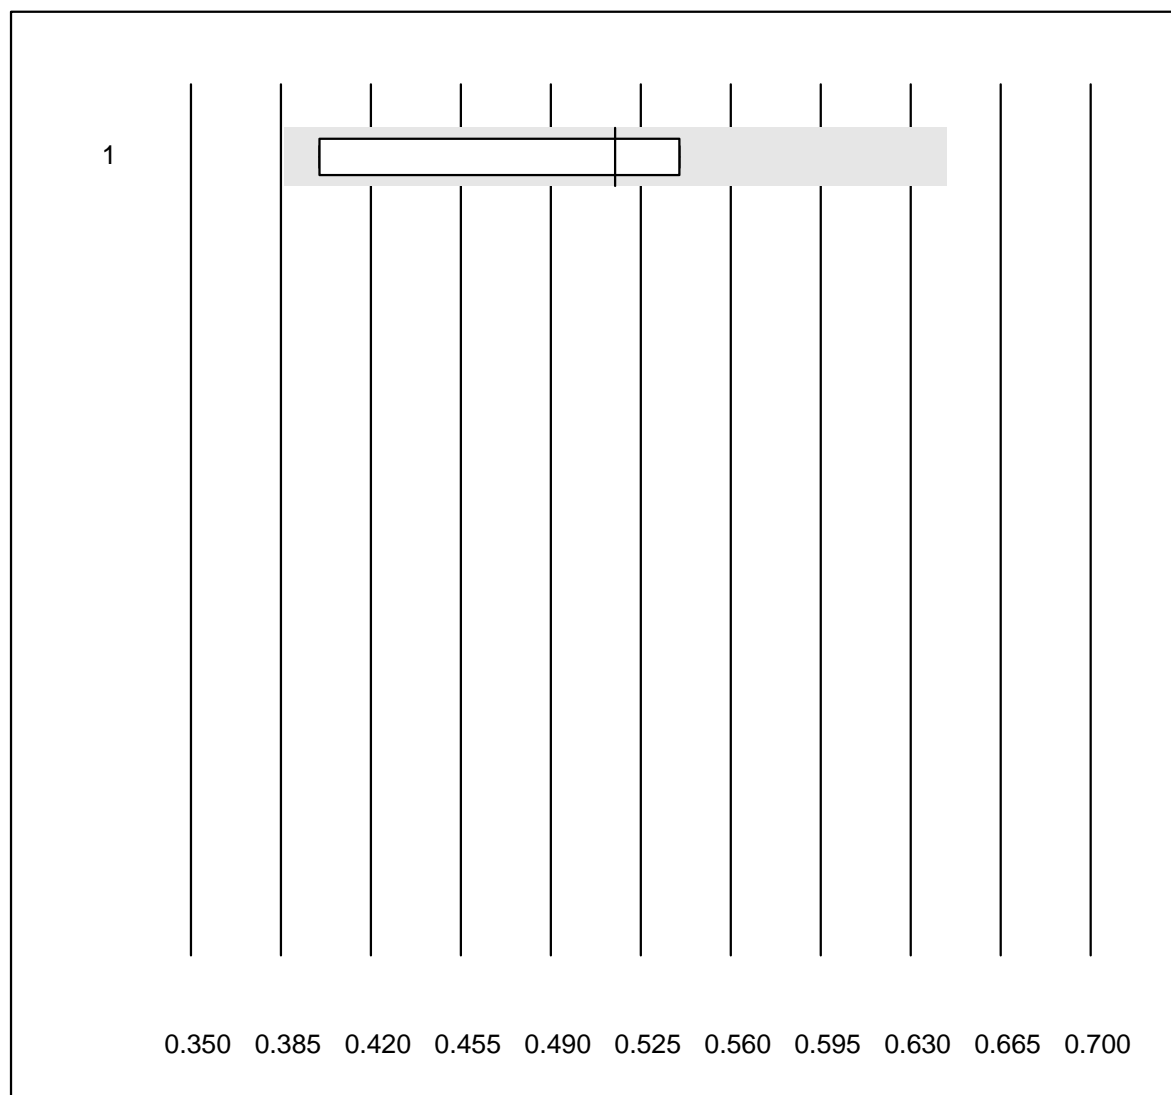


Tolérance MQ : 25 %

Ethylglucuronid (mg/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	4	75.0	0.0	25.0	0.52	14.9	e*

Microalbumine

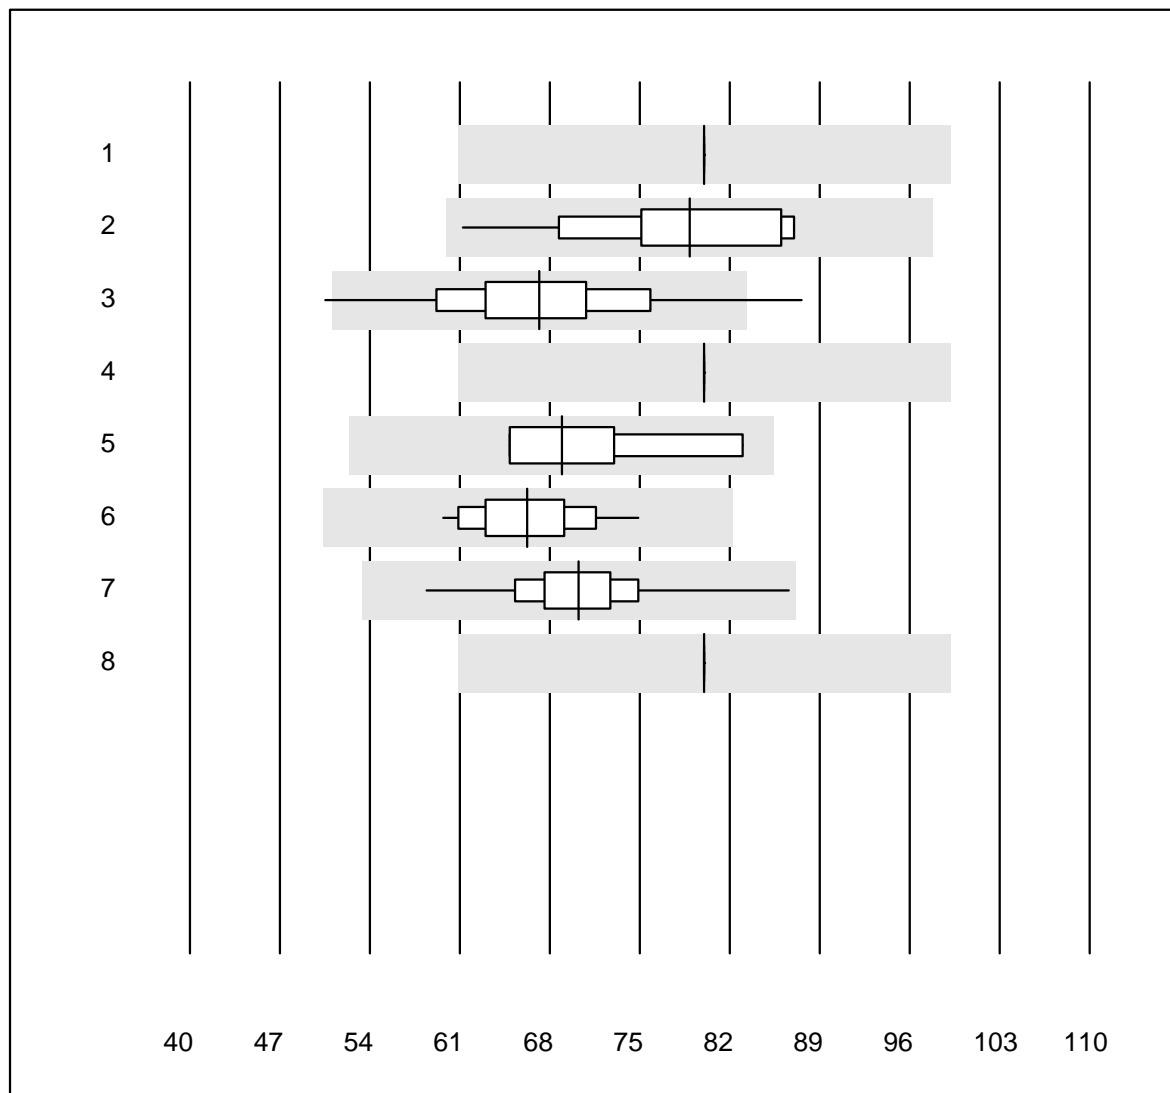


QUALAB Tolérance : 24 %

Microalbumine (mg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Aution	5	40.0	0.0	60.0	80.0	0.0	a
2 AFIAS	11	100.0	0.0	0.0	78.9	10.5	e*
3 Afinion	448	97.3	1.8	0.9	67.2	9.6	e
4 Sysmex U	18	50.0	0.0	50.0	80.0	0.0	a
5 Autres méthodes	6	66.7	0.0	33.3	69.0	10.1	e*
6 Turbidimétrie	27	100.0	0.0	0.0	66.2	6.3	e
7 DCA2000/Vantage	147	95.9	0.0	4.1	70.2	6.2	e
8 Siemens Clinitek	15	33.3	0.0	66.7	80.0	0.0	a

Créatinine urine

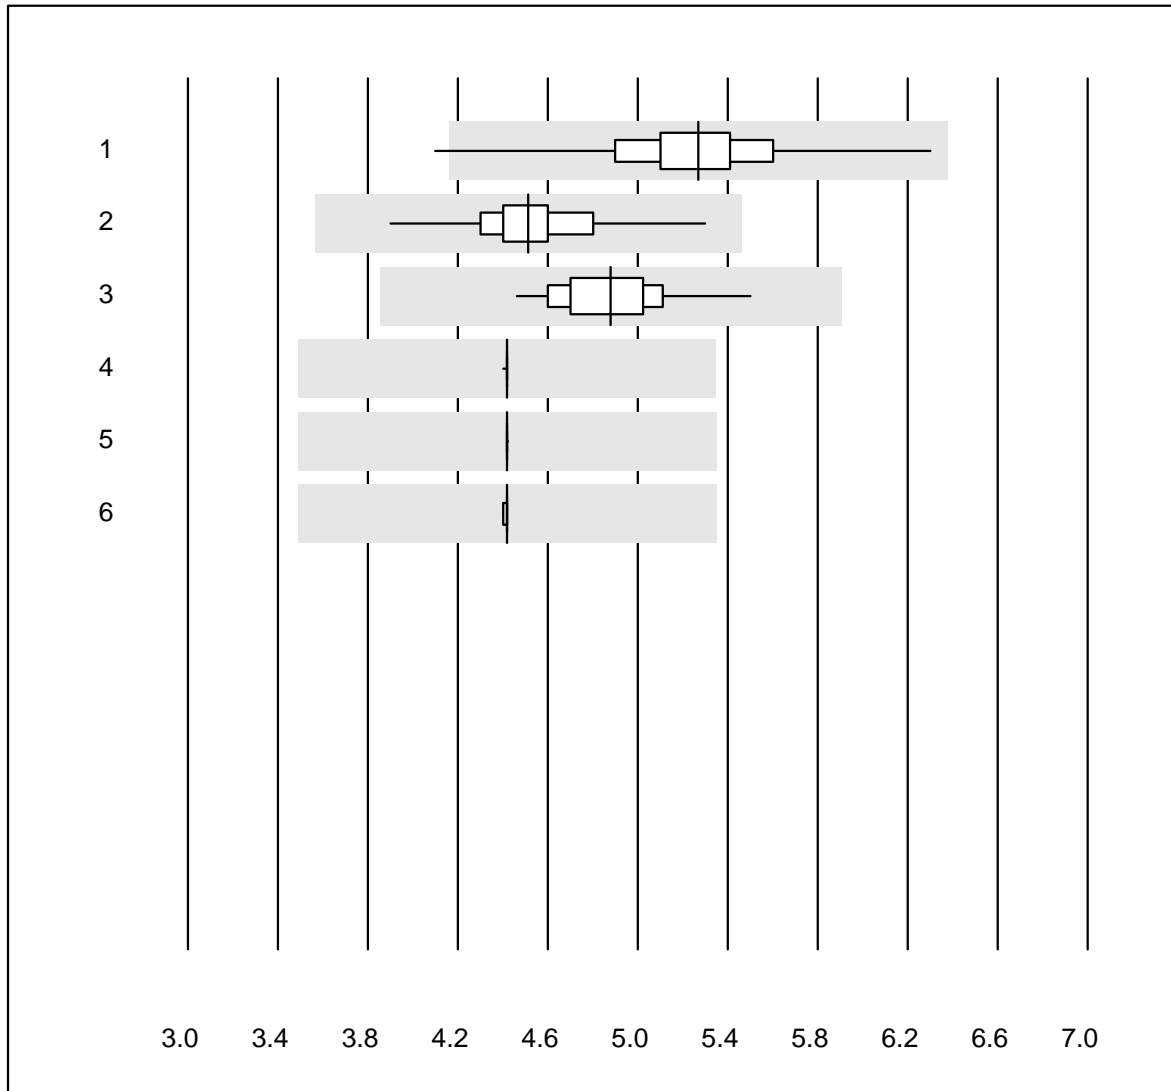

QUALAB Tolérance : 21 %

Créatinine urine (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	DCA2000/Vantage	147	94.5	1.4	4.1	5.3	6.2	e
2	Afinion	448	99.3	0.0	0.7	4.5	5.0	e
3	Chimie humide	41	97.6	0.0	2.4	4.9	4.6	e
4	Sysmex U	16	68.7	0.0	31.3	4.4	0.1	e
5	Aution	5	40.0	0.0	60.0	4.4	0.0	a
6	Siemens Clinitek	15	33.3	0.0	66.7	4.4	0.2	a