

Verein für  
Association pour le  
Associazione per il



medizinische Qualitätskontrolle  
contrôle de qualité médical  
controllo di qualità medico

# **Commentaire de l'essai interlaboratoire**

## **2022 - 1**

### Échantillons de l'essai interlaboratoire

L'homogénéité et la stabilité ont été vérifiées pour tous les échantillons avant respectivement pendant l'envoi et aucune anomalie n'a été constatée. Les tests de conformité ont été réalisés par les laboratoires de l'Hôpital Universitaire de Zürich (<http://www.uzl.usz.ch/>).

Ont été produits spécifiquement pour MQ en sous-traitance les échantillons d'essai interlaboratoire suivants:

B1 Strep A Test, B2 Uricult, H4 Hématologie parasitaire, K14 Marqueur tumoral

### Détermination des valeurs-cible

Pour chaque valeur-cible est indiqué le mode de détermination utilisé selon les termes de la norme ISO17043:2010, B2.1 (Colonne "Type"):

- a Valeur connue, sur la base de la production.
- b Valeur de référence certifiée lors de l'utilisation d'échantillons spécifiques
- c Valeur de référence déterminée par analyse
- d „Consensus value“ des laboratoires d'experts
- e „Consensus value“ des participants

Pour les groupes de méthode incluant plus de 9 participants, les valeurs cibles sont déterminées comme étant la „Consensus value“ ("e") des participants. Pour la détermination de ces valeurs cibles est utilisée la moyenne réalisée par le groupe de méthodes. Les résultats qui présentent un écart par rapport à la valeur cible supérieur à 1.5 fois la tolérance Qualab, sont considérés comme résultats aberrants et exclus du calcul de la valeur de référence. Les résultats des essais d'aptitude sont utilisés comme valeur de base pour éliminer les taux aberrants. Afin de mettre à disposition de tous les participants des valeurs-cible les plus pertinentes possibles, d'autres procédures peuvent également être utilisées pour des groupes de méthode plus restreints.

### Incertitude dans la détermination des valeurs-cible

L'incertitude-type ( $u_x$ ) est calculée à l'aide de la formule suivante (ISO13528):

$$u_x = (\text{Valeur-cible}/100) * (1.25/\text{Racine carrée du "nombre des participants"}) * \text{CV en \%}$$

- $u_x$  est exprimée dans la même unité que la valeur-cible
- $u_x$  peut être comparée avec l'écart-type du collectif des participants ( $\text{Ecart-type} = \text{Valeur-cible} * \text{CV en \%} / 100$ )
- Pour un nombre de participants  $>18$ , l'incertitude-type ( $u_x$ ) est significativement plus petite que la dispersion du collectif des participants et peut donc être négligée.


### Tolérances QUALAB et MQ

Pour les analyses obligatoires sont utilisées les tolérances fixées par Qualab ([www.qualab.ch](http://www.qualab.ch), contrôle de qualité externe). Pour les analyses non-obligatoires, les tolérances sont fixées par le directeur de MQ pilotant l'essai interlaboratoire.

Si l'incertitude déterminée de la valeur de référence  $u_x$  est supérieure à 15% de la tolérance QUALAB ou de MQ, la lettre qui caractérise le type de détermination de la valeur-cible est en outre marquée d'une étoile (par exemple "e\*"). Nous rendons ainsi les participants attentifs au fait que l'incertitude de la valeur de référence peut avoir une influence sur l'évaluation.

### Représentation graphique

La représentation graphique des résultats est la suivante:

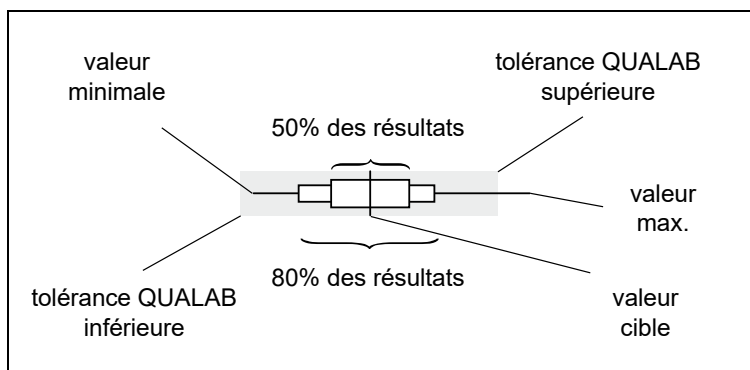


### **Comparaison des appareils**

Les données de ce rapport vous permettent de comparer les performances respectives des divers appareils. Toutefois, vous devez tenir compte des points suivants:

- Le contrôle Chimie K1 est un sérum de contrôle commercialisé prêt à l'emploi. Même si l'échantillon est d'origine humaine, des effets matriciels sont possibles. Ceux-ci dépendent de l'appareil et peuvent générer des valeurs cible différentes.
- Seul un échantillon a été mesuré. La dispersion des résultats étant dépendante de la nature de l'échantillon (effets matriciels) et du niveau du résultat, les coefficients de variation déterminés (CV en %) ne sont pas toujours valables.
- Une grande partie des taux aberrants est due à des erreurs administratives (erreur d'unité, confusion des résultats) ou à des erreurs de manipulation (erreur d'échantillon, dissolution incorrecte, mélange insuffisant) et n'a rien à voir avec le type d'appareil.


Zürich, 11.4.2022



Dr. R. Fried  
Directeur de l'essai interlaboratoire

*Il n'est pas autorisé de publier une partie ou l'intégralité de ce rapport sans notre accord écrit préalable. L'original est conservé dans les archives sous [www.mqzh.ch](http://www.mqzh.ch).*

## Quick OA

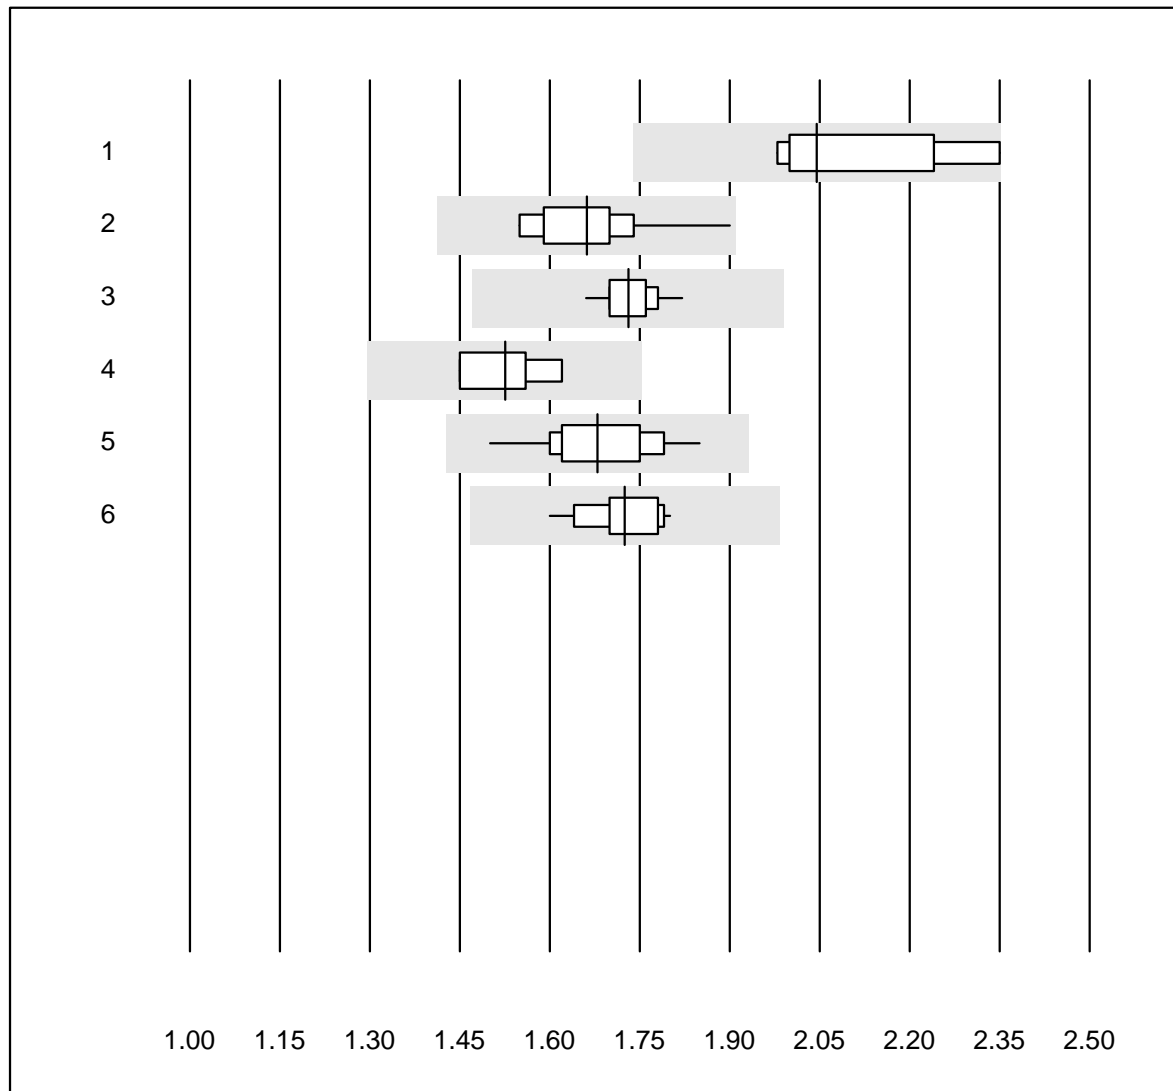


QUALAB Tolérance : 15 %

Quick OA ( )


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Neoplastin Plus	6	100.0	0.0	0.0	2.05	7.2	e*
2 Innovin	14	100.0	0.0	0.0	1.66	5.7	e
3 Recombiplastin 2G	11	100.0	0.0	0.0	1.73	2.5	e
4 Eurolyser	4	100.0	0.0	0.0	1.53	4.9	e*
5 Autres méthodes	14	100.0	0.0	0.0	1.68	5.3	e
6 Neoplastin R	12	100.0	0.0	0.0	1.73	3.6	e

## Fibrinogène OA

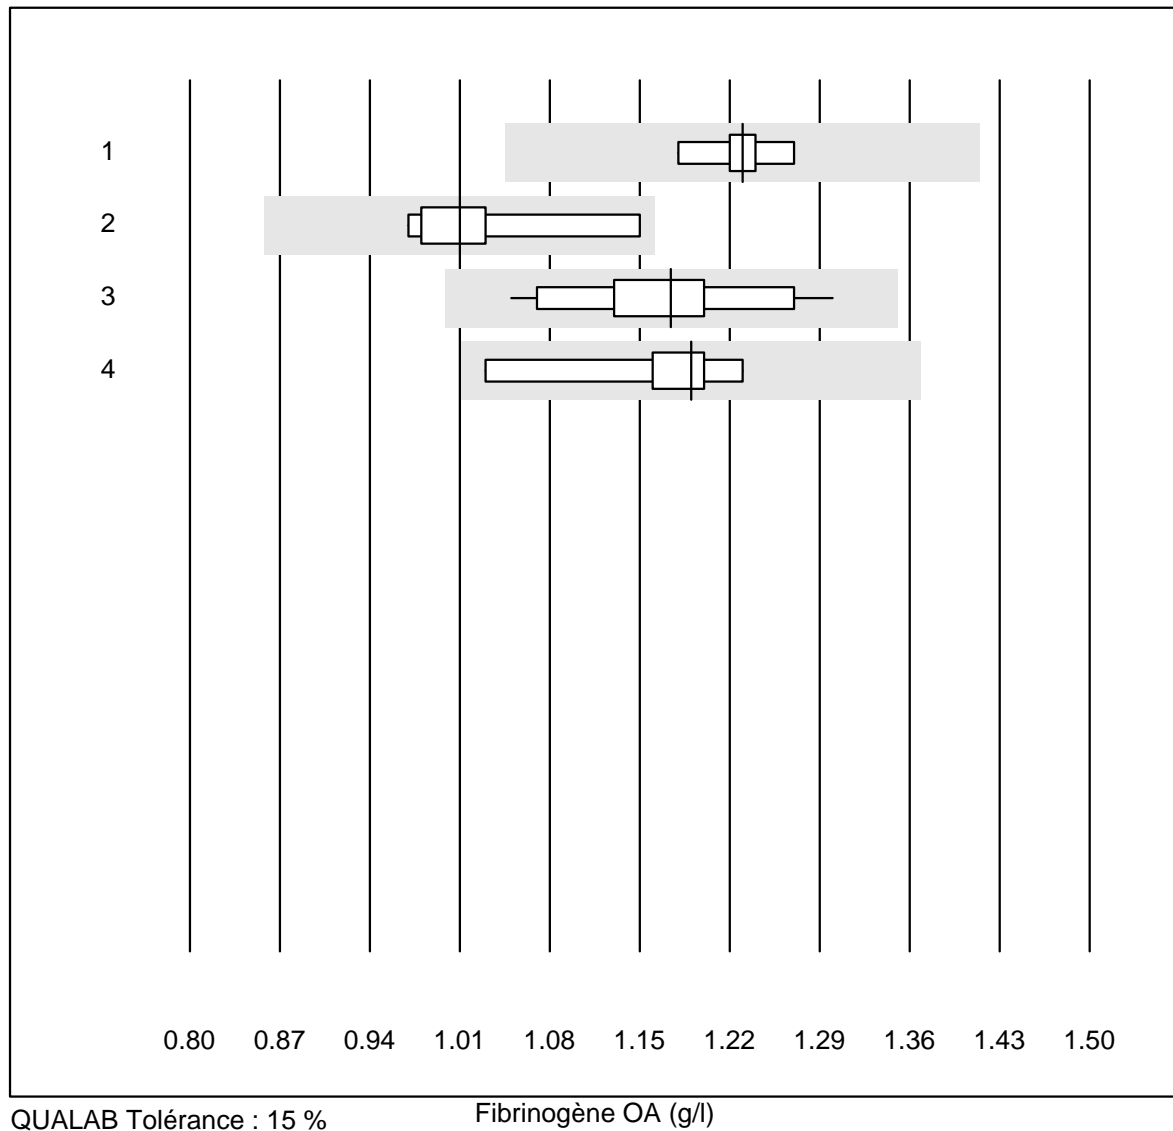

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Autres méthodes	6	100.0	0.0	0.0	1.23	2.4	e
2 Siemens Thrombin	6	100.0	0.0	0.0	1.01	6.4	e*
3 Stago/STA	16	100.0	0.0	0.0	1.17	5.9	e
4 Fibrinogen Q.F.A.	5	100.0	0.0	0.0	1.19	6.7	e*

## aPTT OA

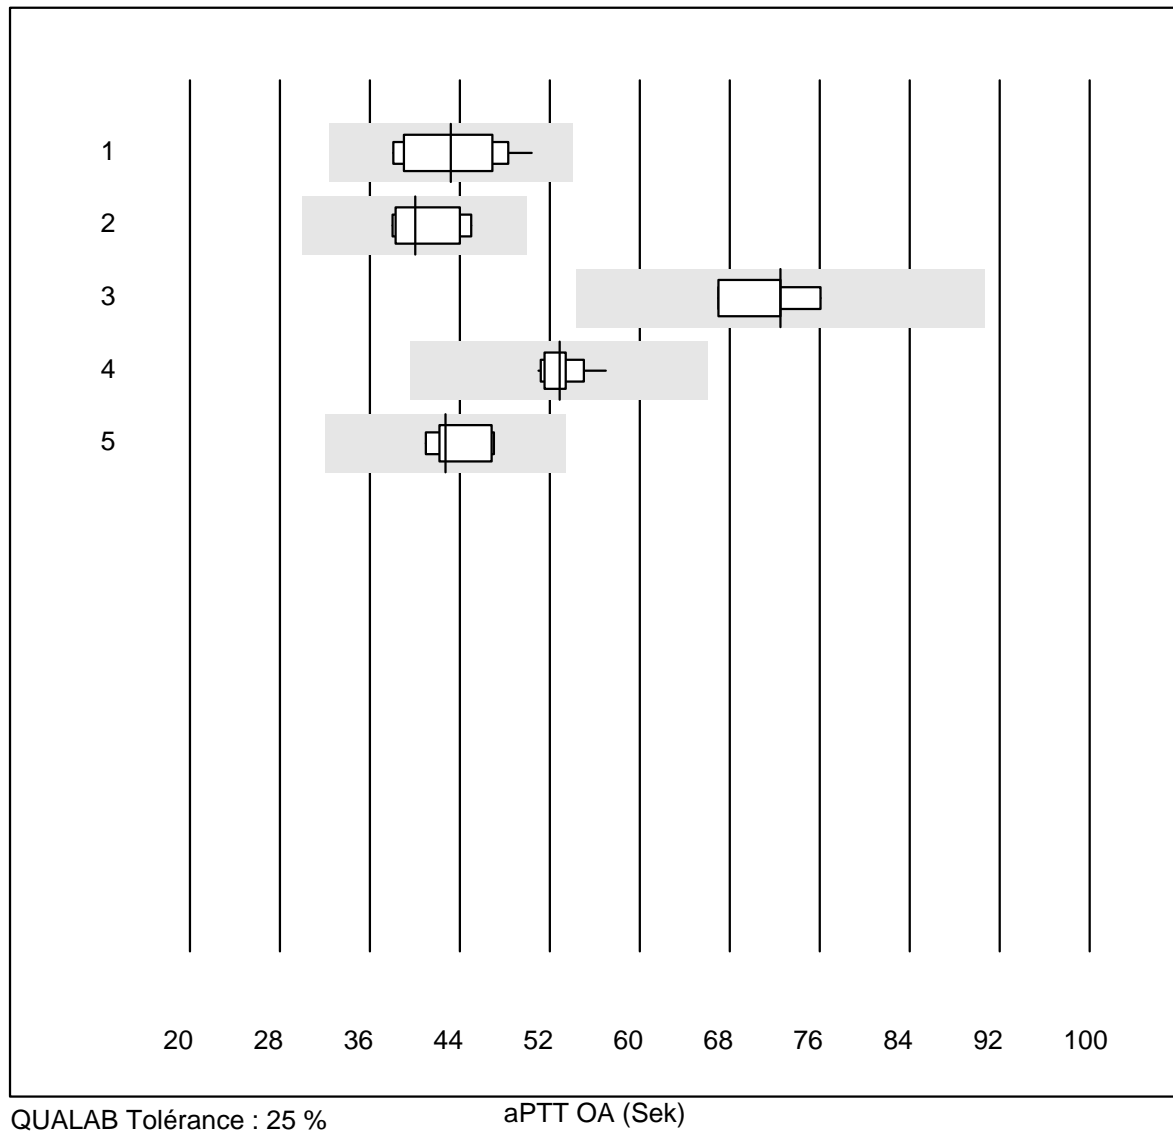


QUALAB Tolérance : 25 %

aPTT OA (Sek)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Autres méthodes	10	100.0	0.0	0.0	43.2	10.3	e*
2 Actin FS	6	100.0	0.0	0.0	40.0	7.4	e*
3 Pathromtin SL	4	100.0	0.0	0.0	72.5	5.8	e
4 Stago/STA	15	100.0	0.0	0.0	52.9	3.0	e
5 aPTT-SP	6	100.0	0.0	0.0	42.8	5.8	e

## INR CoaguChek

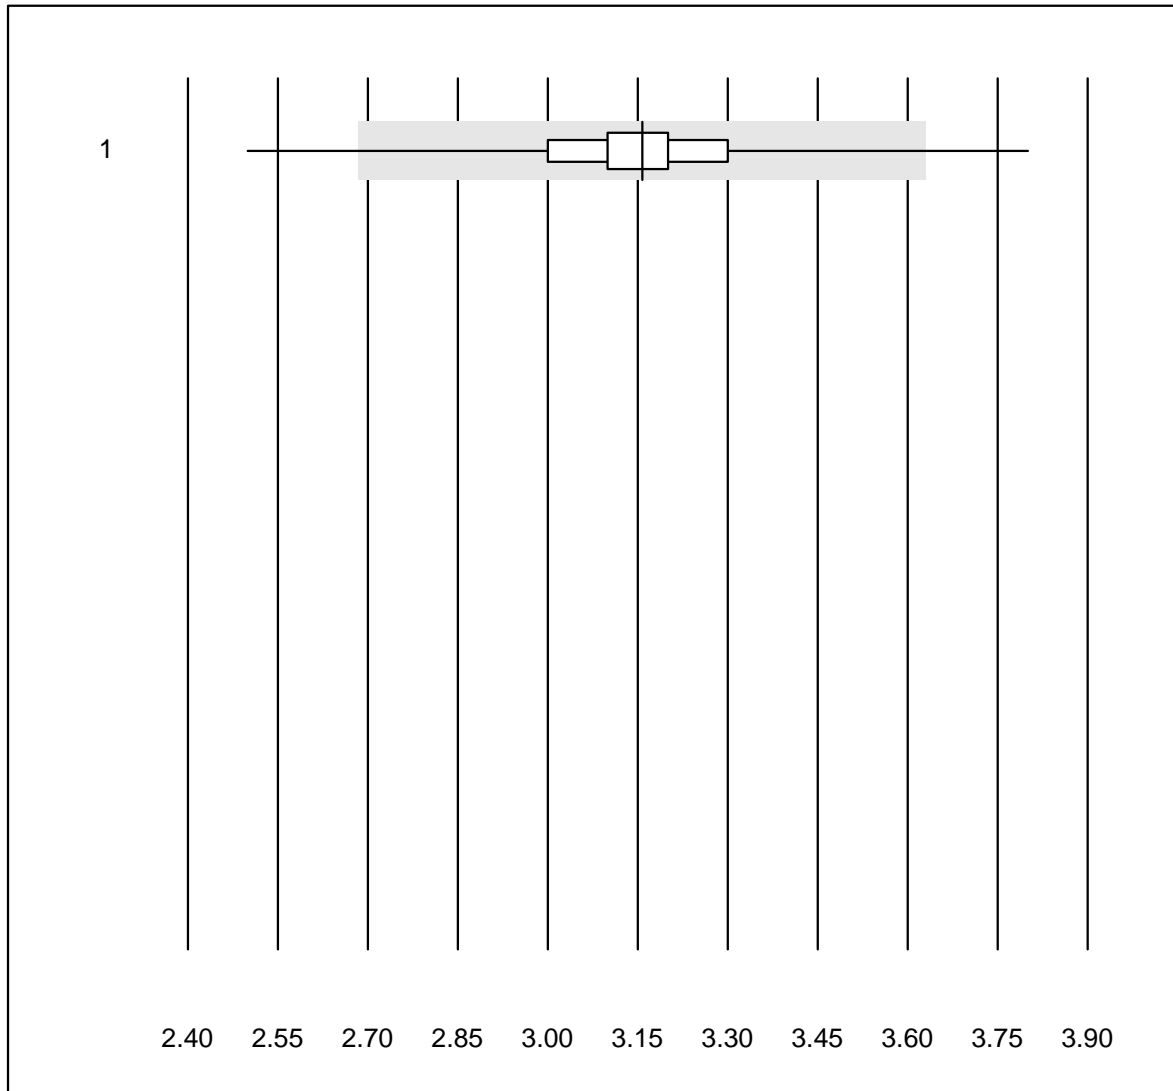


QUALAB Tolérance : 15 %

INR CoaguChek ()

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 CoaguChek Pro II	719	98.7	0.6	0.7	3.2	3.5	e


## Quick N

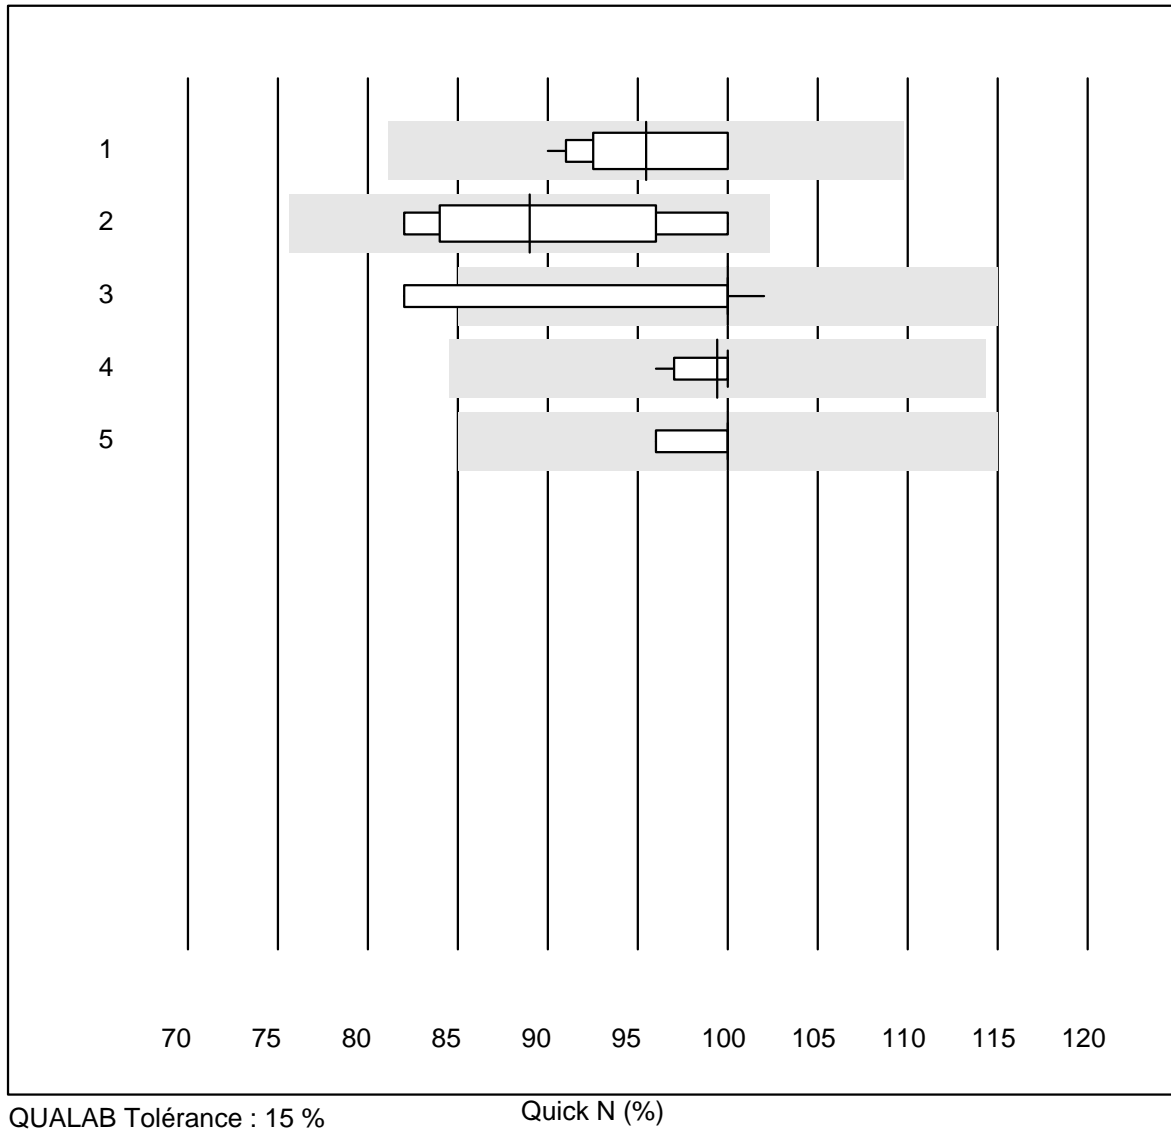

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Neoplastin R	12	100.0	0.0	0.0	95	4.1	e
2 Neoplastin Plus	6	100.0	0.0	0.0	89	8.0	e*
3 Innovin	10	90.0	10.0	0.0	100	5.9	e*
4 toutes les méthodes	12	100.0	0.0	0.0	99	1.4	e
5 Recombiplastin 2G	7	100.0	0.0	0.0	100	1.5	e



## Faktor II

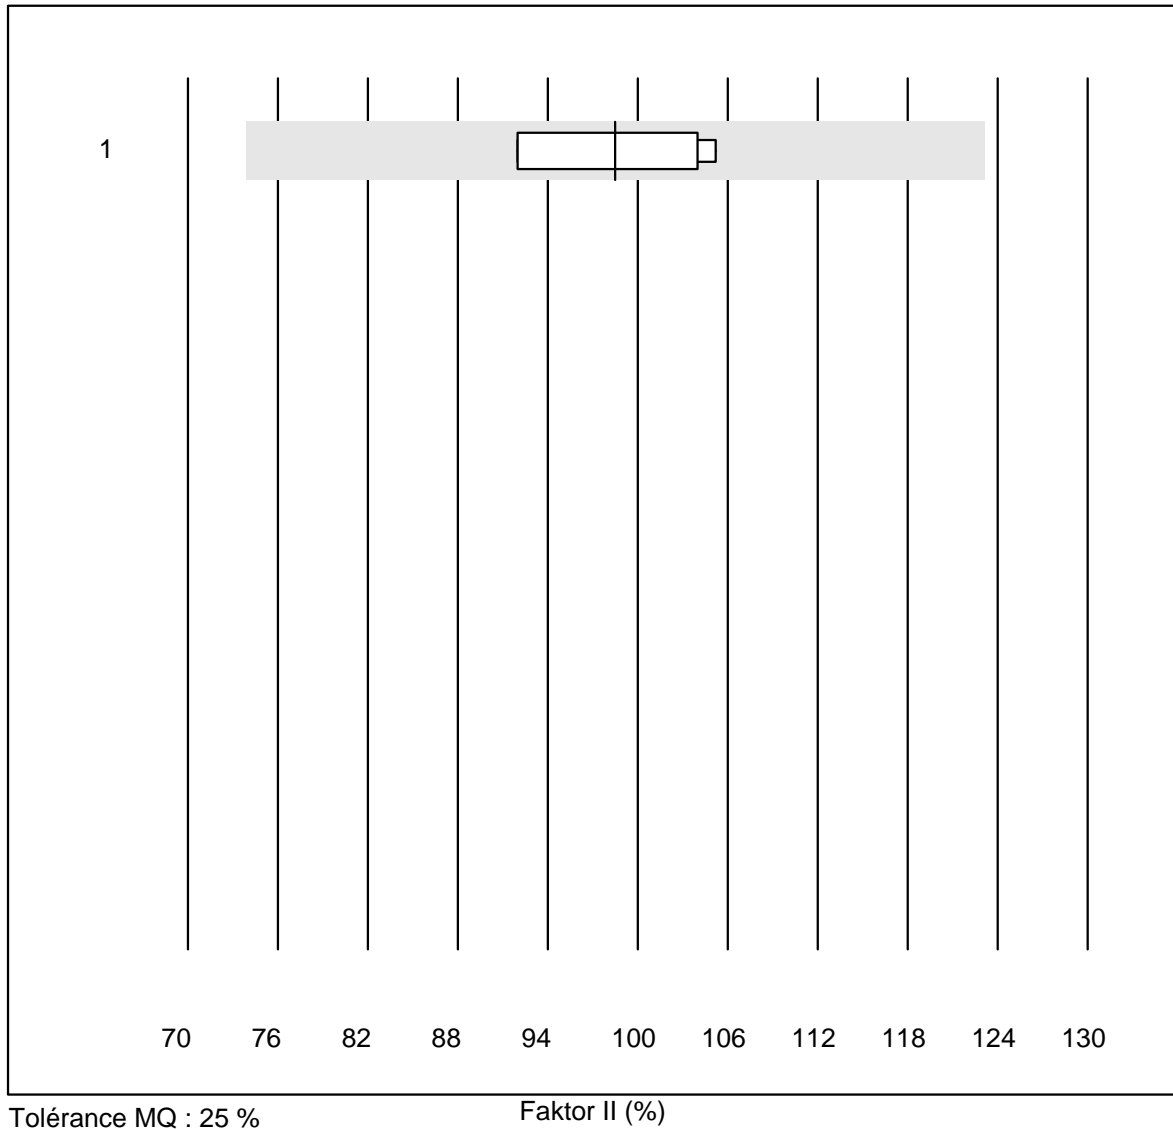


Tolérance MQ : 25 %

Faktor II (%)


No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	98.5	7.1	e*

## Fibrinogen N

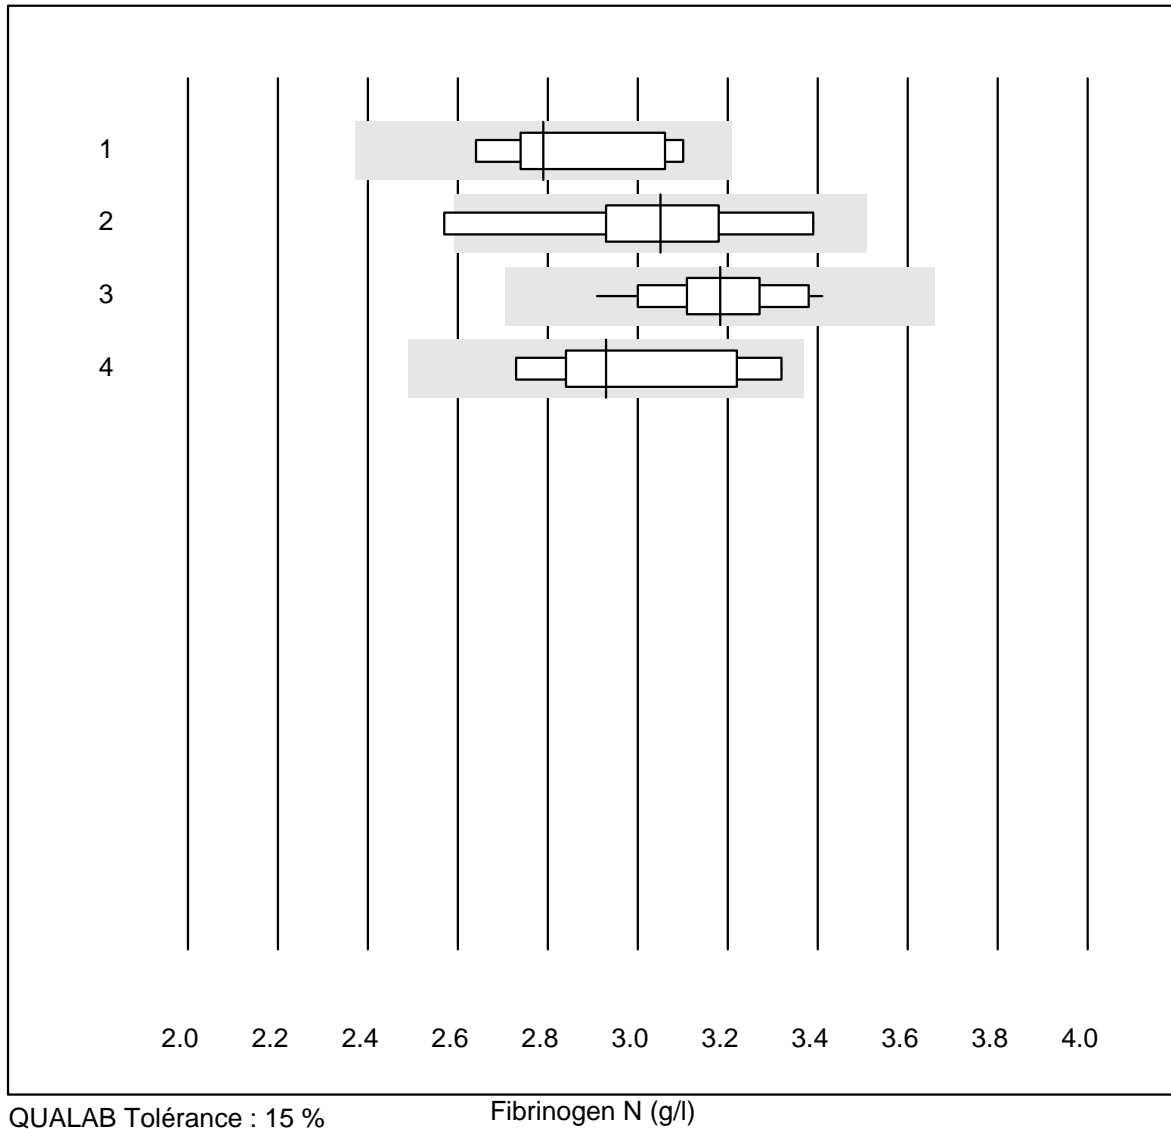

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Siemens Thrombin	6	83.3	0.0	16.7	2.79	6.9	e*
2 Autres méthodes	9	88.9	11.1	0.0	3.05	8.8	e*
3 Stago/STA	18	100.0	0.0	0.0	3.18	4.2	e
4 Fibrinogen Q.F.A.	6	100.0	0.0	0.0	2.93	7.7	e*

## Faktor V

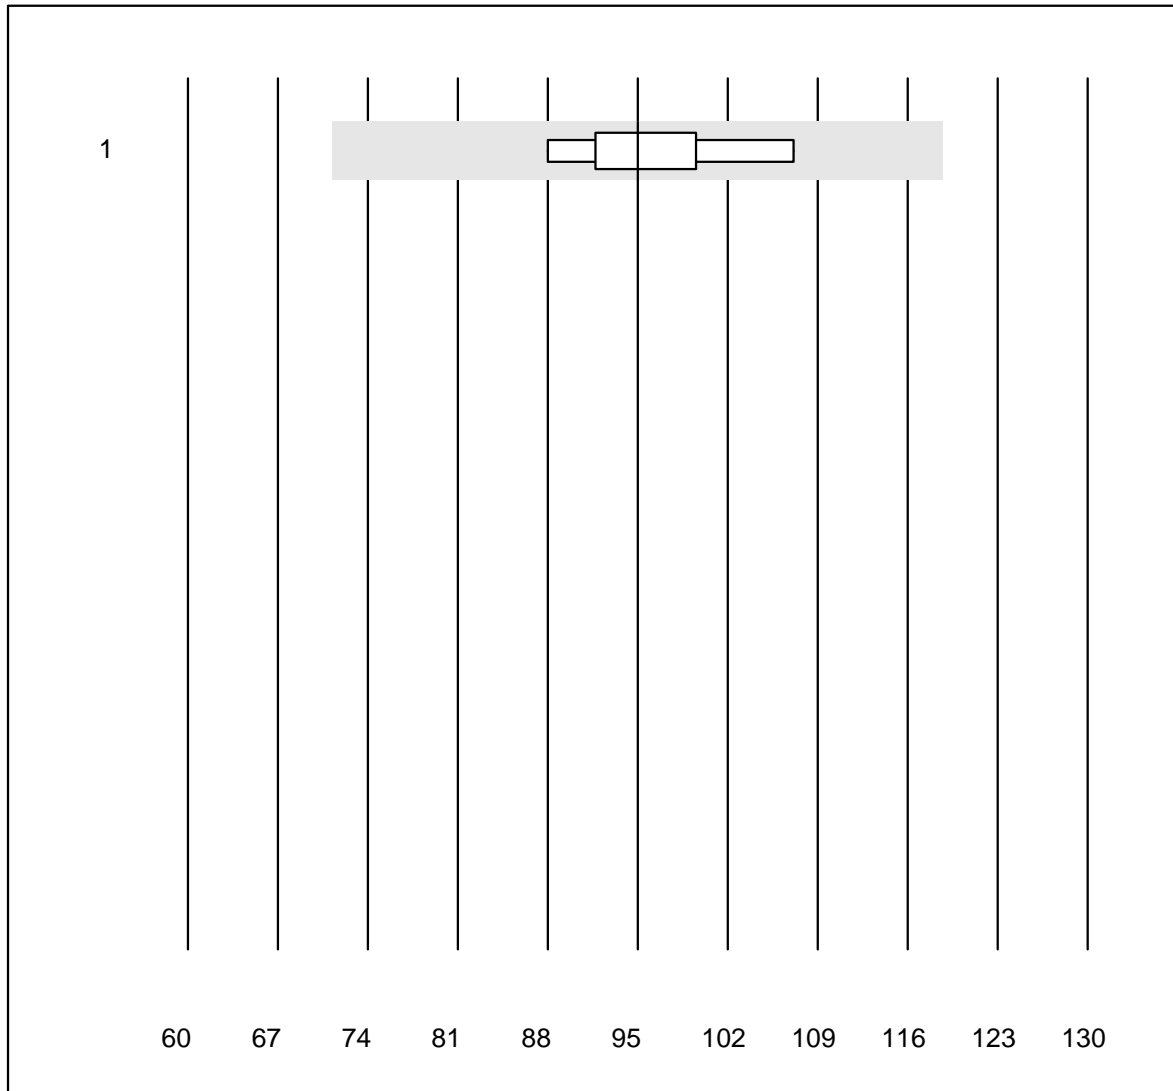


Tolérance MQ : 25 %

Faktor V (%)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	95.0	6.5	e

## aPTT N

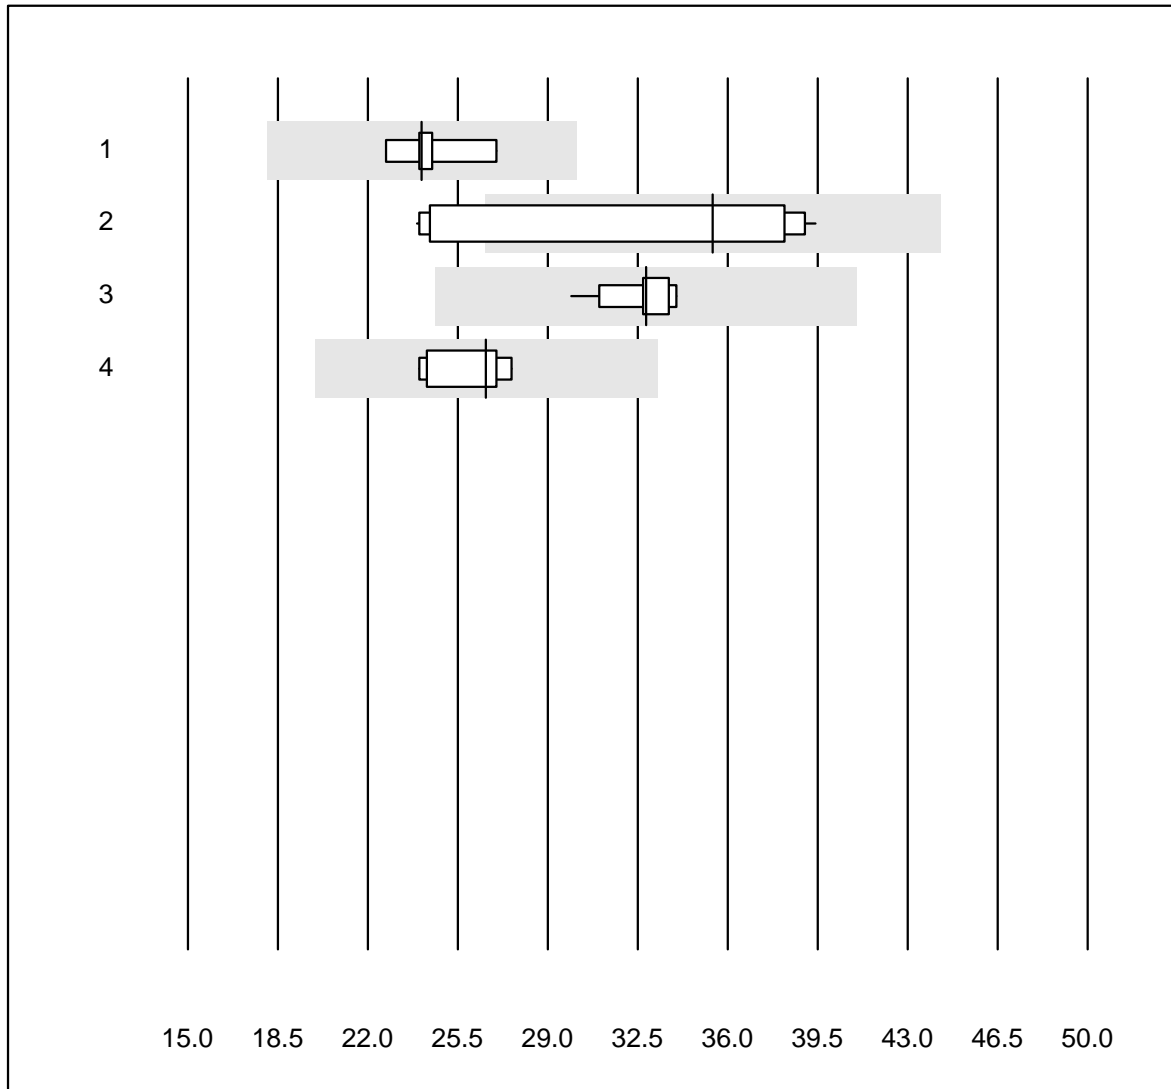


QUALAB Tolérance : 25 %

aPTT N (Sek)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Actin FS	5	100.0	0.0	0.0	24.1	6.4	e
2 Autres méthodes	12	75.0	25.0	0.0	35.4	20.3	e*
3 Stago/STA	18	100.0	0.0	0.0	32.8	3.3	e
4 aPTT-SP	9	88.9	0.0	11.1	26.6	5.2	e

## Faktor VII

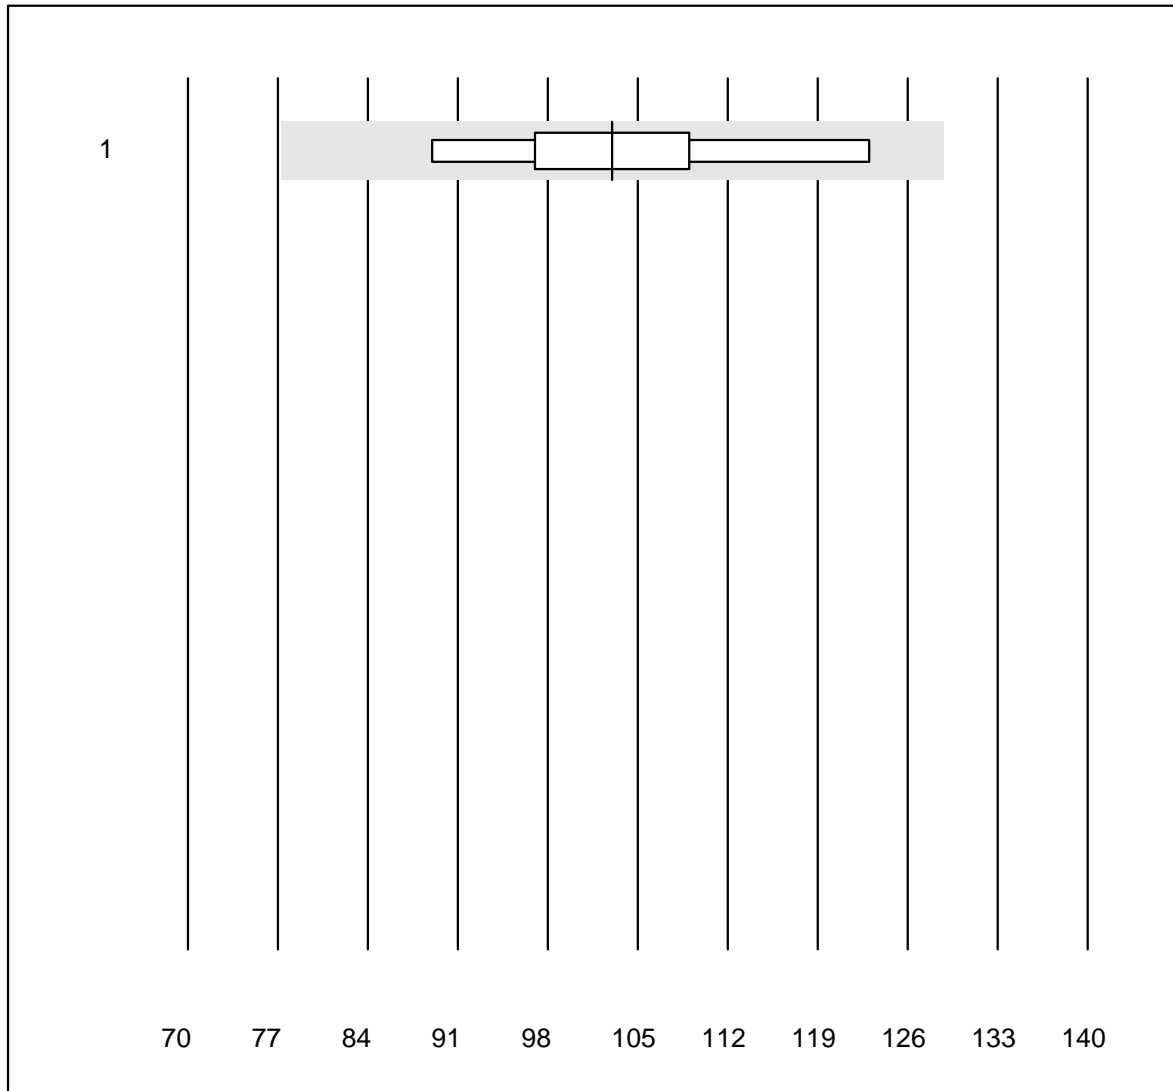


Tolérance MQ : 25 %

Faktor VII (%)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	103.0	12.3	e*

## Quick H

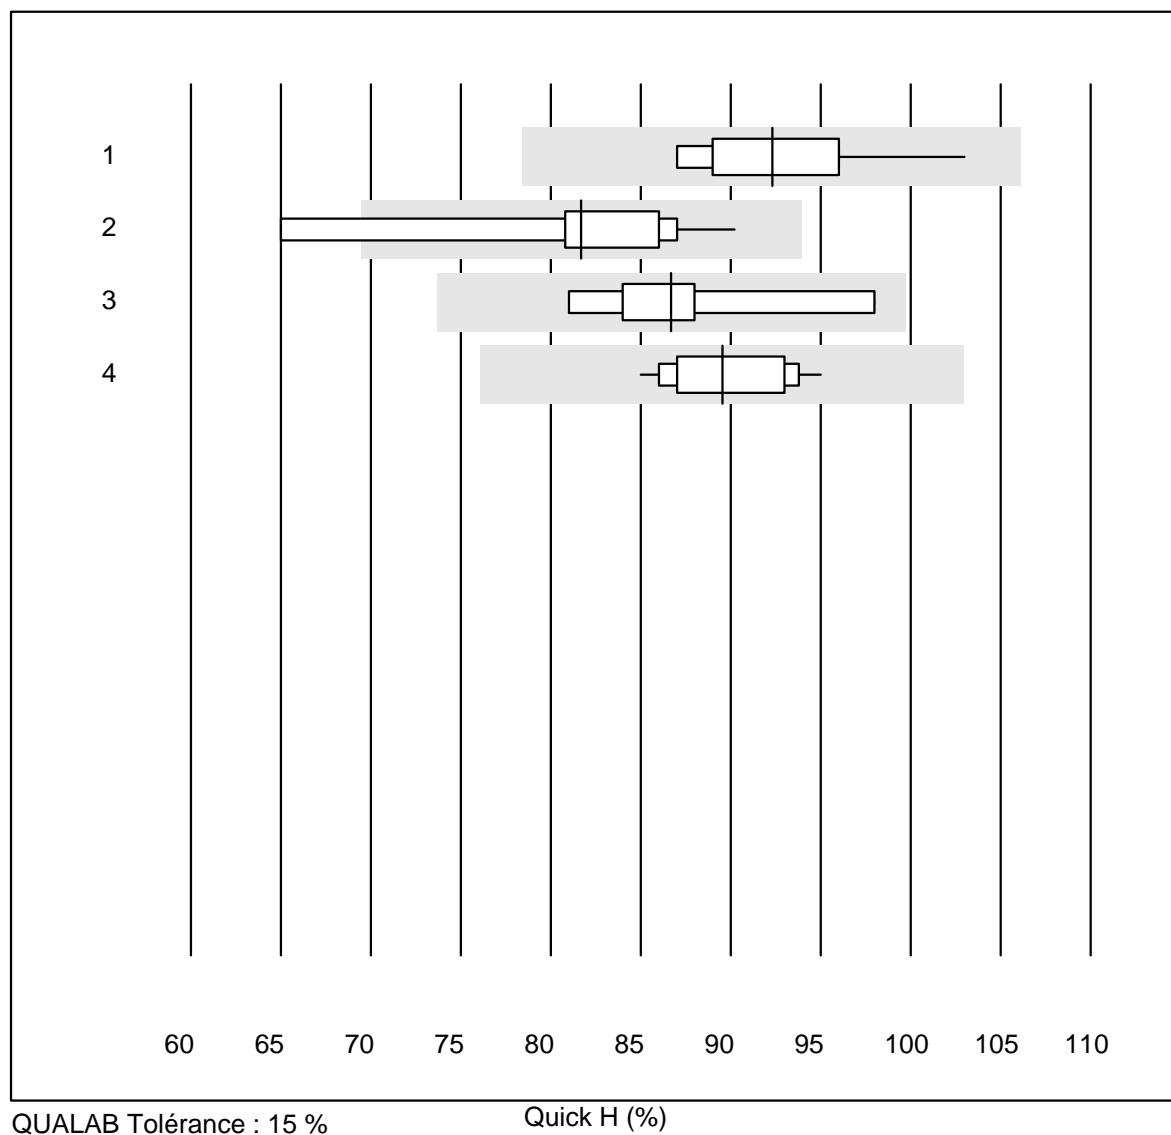


QUALAB Tolérance : 15 %

Quick H (%)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Neoplastin R	10	100.0	0.0	0.0	92	5.3	e
2 Innovin	10	90.0	10.0	0.0	82	8.6	e*
3 toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	87	6.1	e*
4 Recombiplastin 2G	11	100.0	0.0	0.0	90	3.8	e

## Anti-FXa (unfrakt-Heparin)

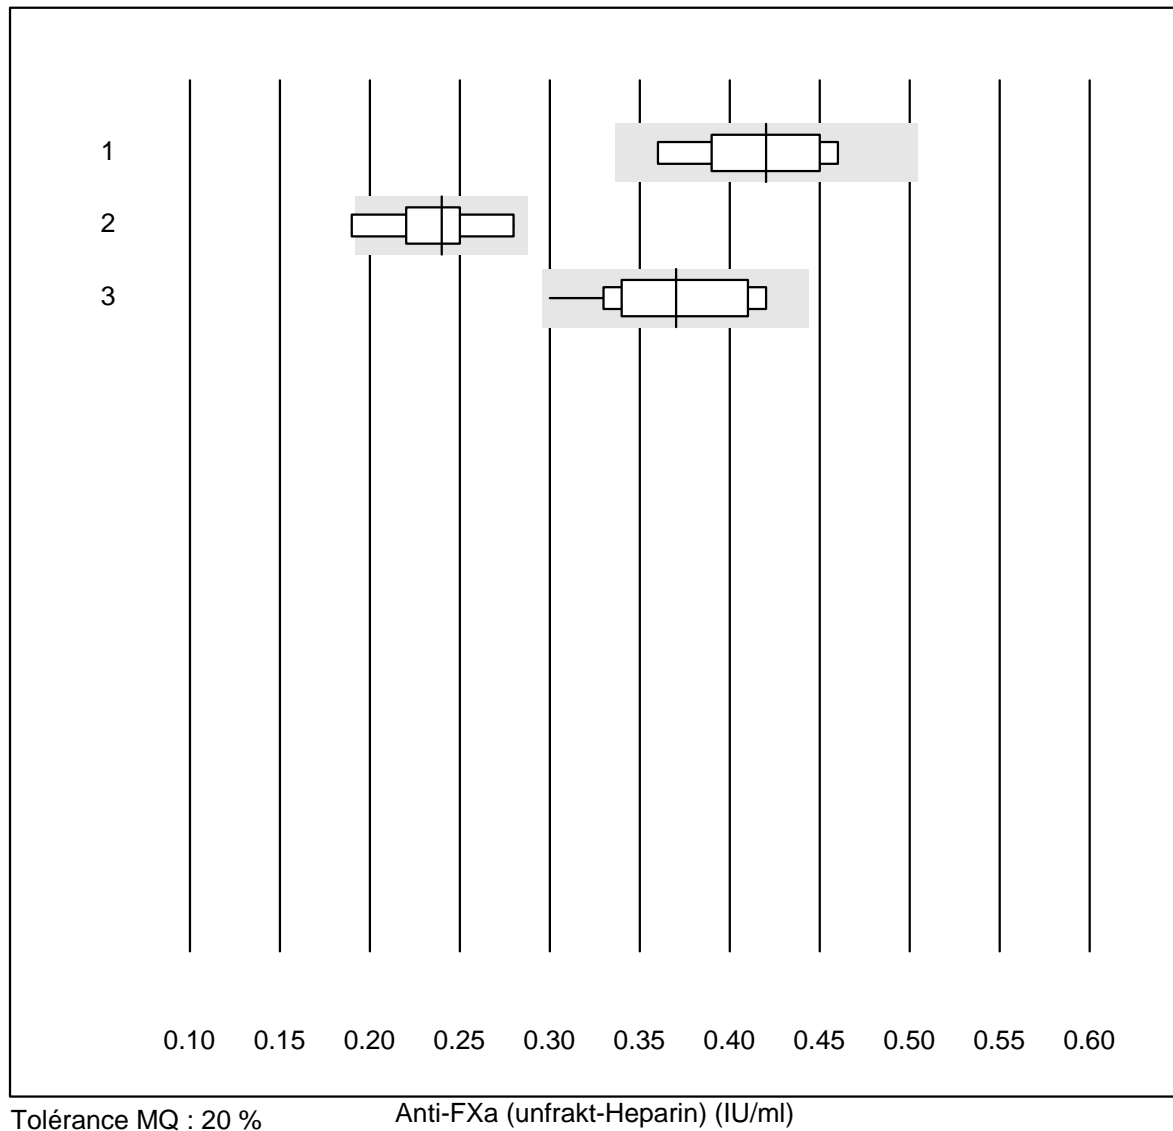


Tolérance MQ : 20 %

Anti-FXa (unfrakt-Heparin) (IU/ml)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	8	87.5	0.0	12.5	0.42	8.3	e*
2 Stago/STA	9	77.8	11.1	11.1	0.24	11.7	e*
3 ACL	15	100.0	0.0	0.0	0.37	10.1	a


## Fibrinogen H

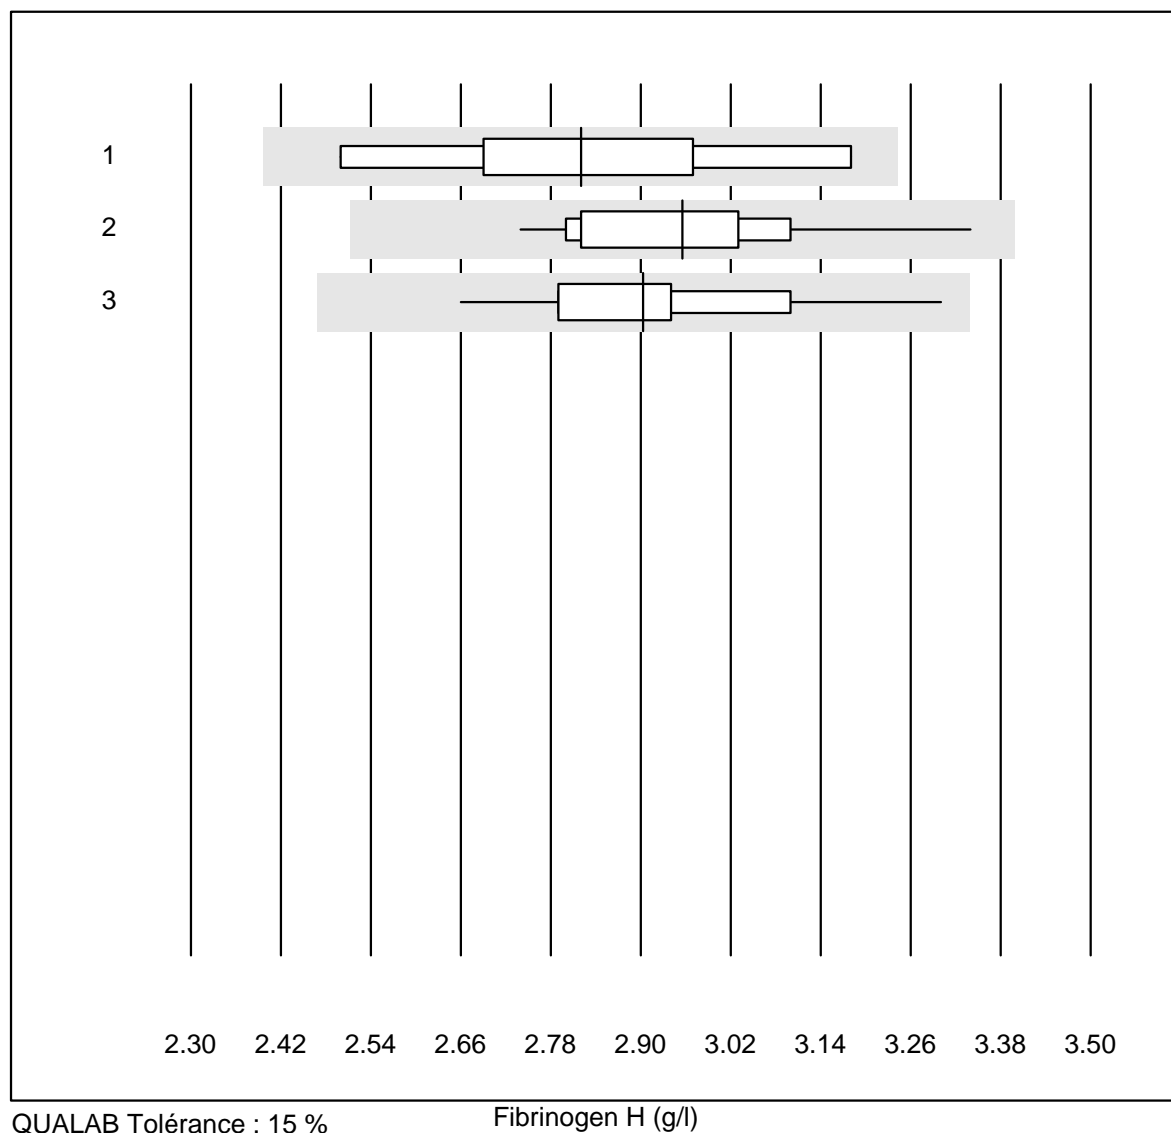

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Autres méthodes	9	100.0	0.0	0.0	2.82	7.8	e*
2 Stago/STA	12	100.0	0.0	0.0	2.96	5.5	e
3 Fibrinogen Q.F.A.	12	100.0	0.0	0.0	2.90	6.1	e




## aPTT H

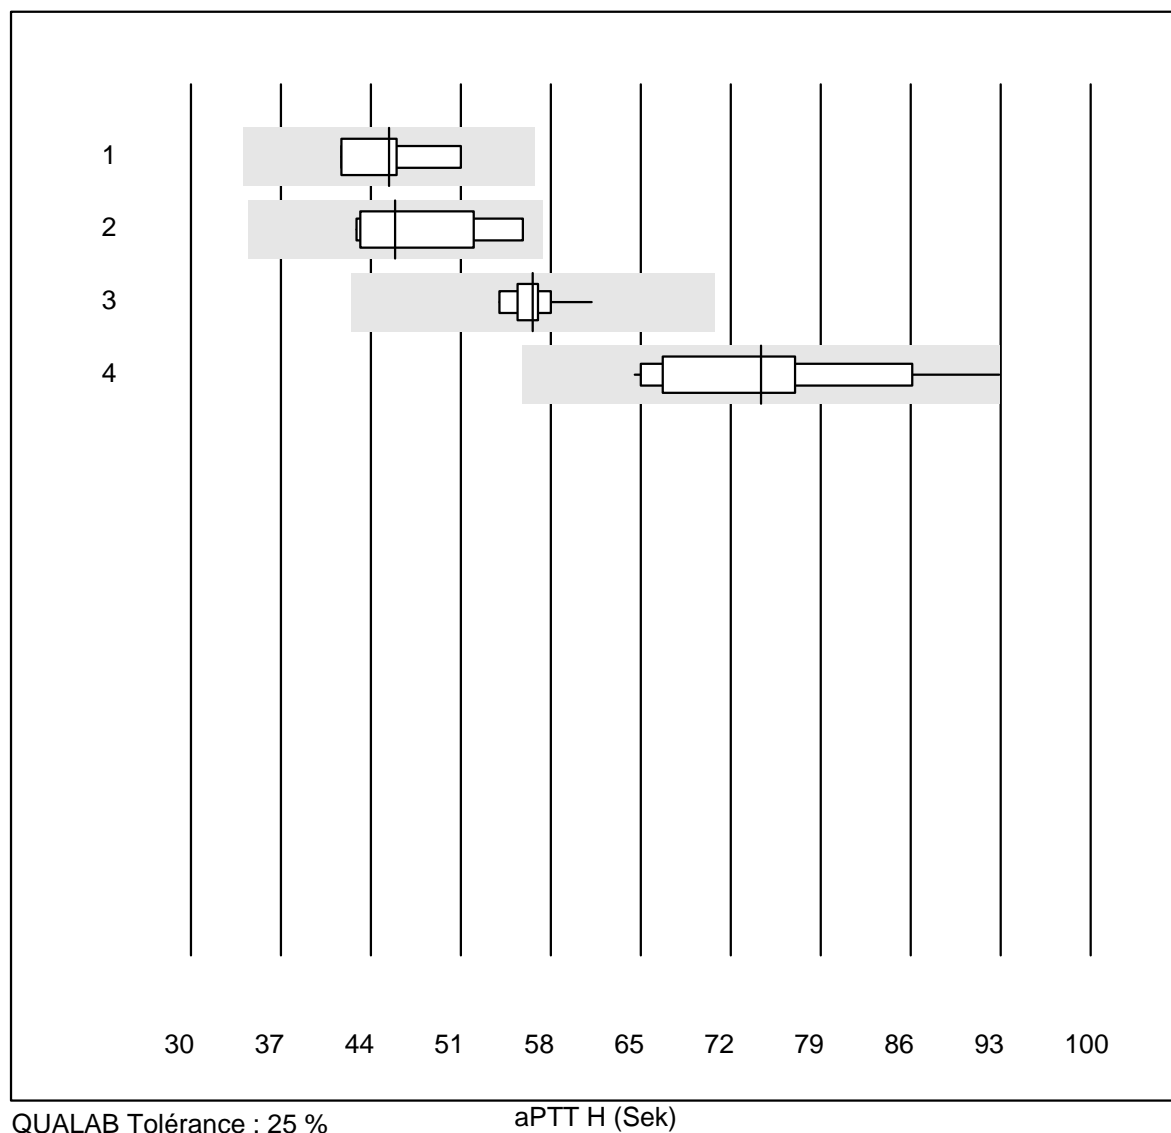


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Actin FS	4	100.0	0.0	0.0	45.4	8.4	e*
2 Autres méthodes	5	100.0	0.0	0.0	45.9	11.9	e*
3 Stago/STA	10	100.0	0.0	0.0	56.6	3.5	e
4 aPTT-SP	12	100.0	0.0	0.0	74.3	12.3	e*

## D-Dimères

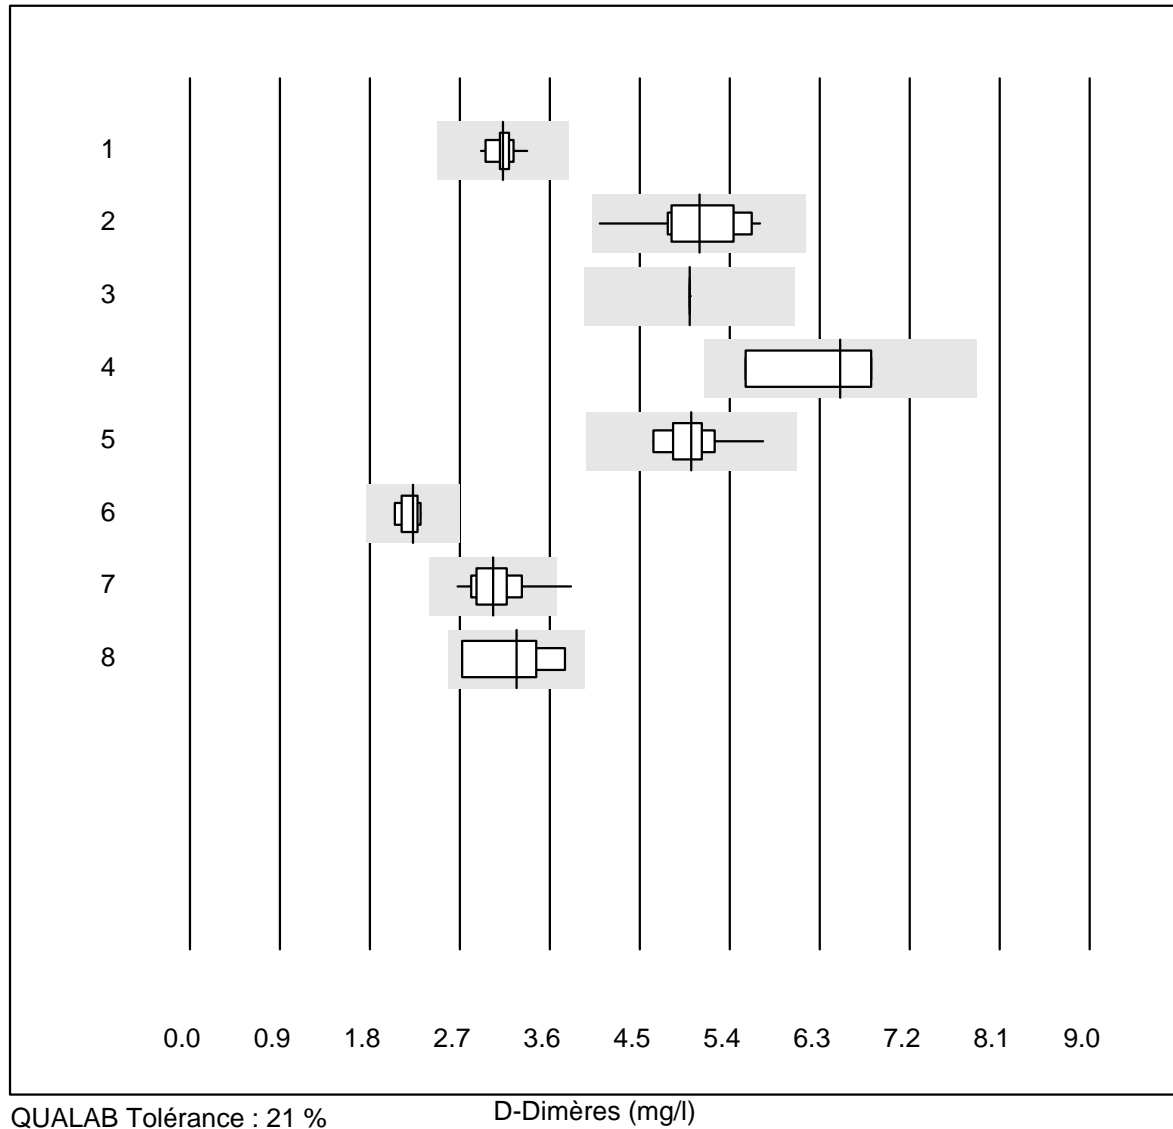

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 STA Liatest	13	100.0	0.0	0.0	3.13	3.9	e
2 Siemens Innovance	11	100.0	0.0	0.0	5.10	9.1	e*
3 Pathfast	8	87.5	0.0	12.5	5.00	0.0	e
4 Eurolyser	4	100.0	0.0	0.0	6.51	9.5	e*
5 ACL	10	100.0	0.0	0.0	5.01	6.1	e
6 AQT 90 FLEX	9	100.0	0.0	0.0	2.23	4.4	e
7 VIDAS	14	92.9	7.1	0.0	3.03	9.2	e
8 autres (0,5)	4	100.0	0.0	0.0	3.27	13.9	e*

## CoaguChek APTT

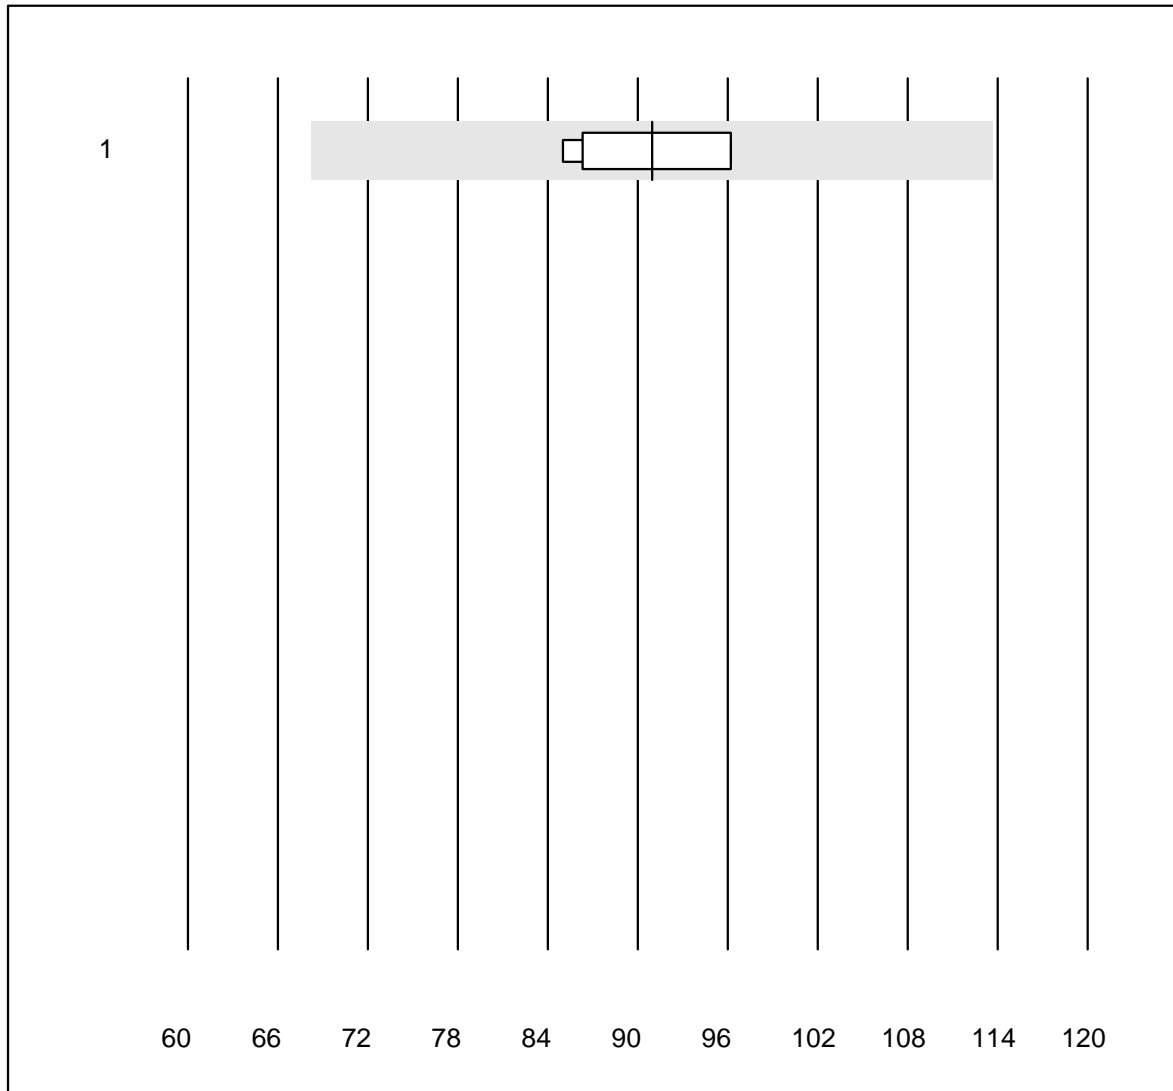


QUALAB Tolérance : 25 %

CoaguChek APTT (Sek)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 CoaguChek Pro II	6	100.0	0.0	0.0	91.0	5.3	e

## INR CCXS

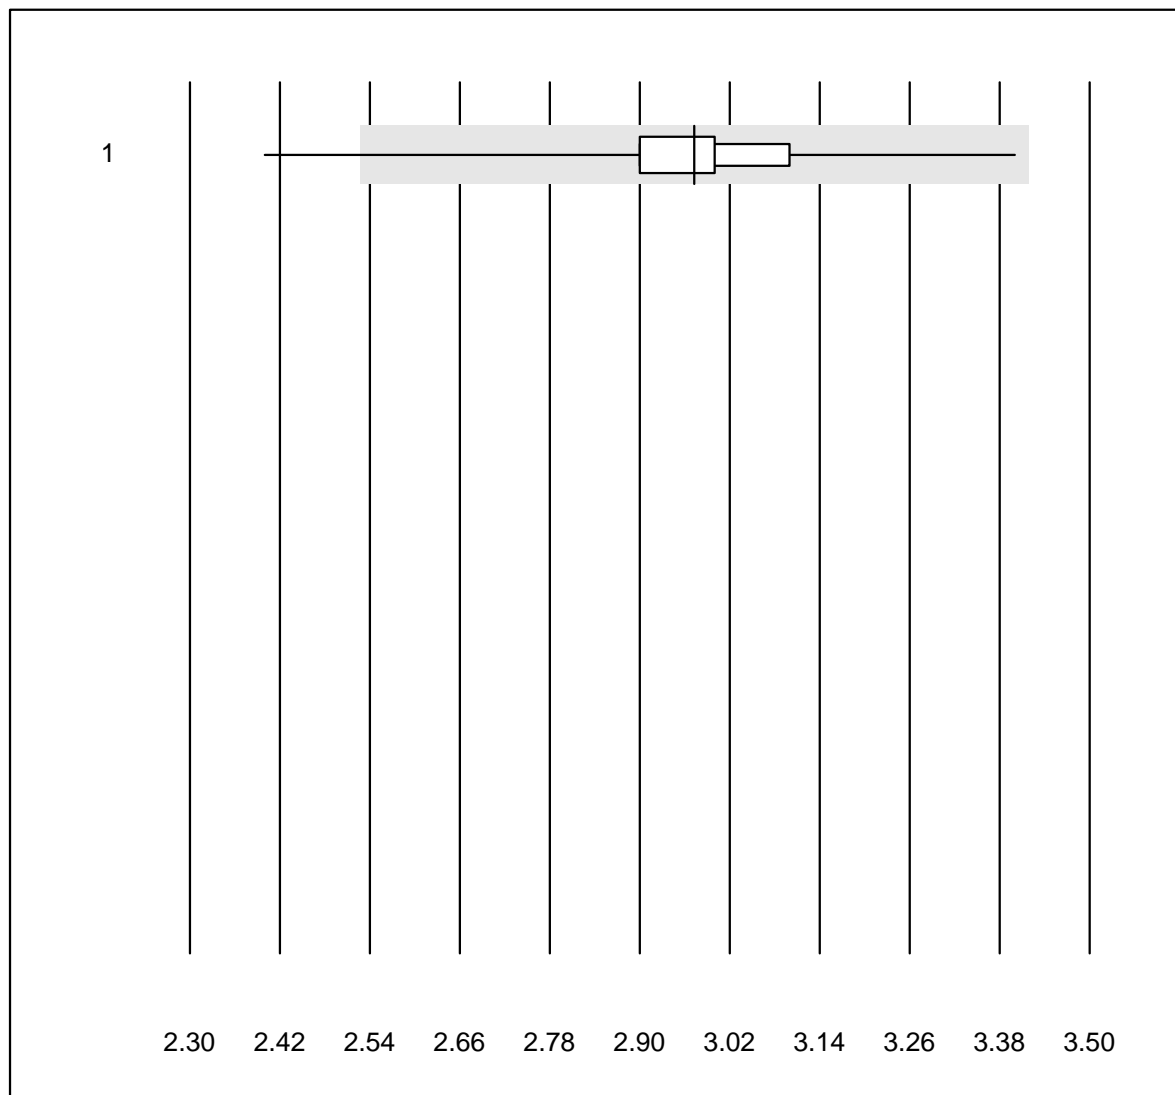


QUALAB Tolérance : 15 %

INR CCXS ()

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 CoaguChek XS	1589	98.8	0.5	0.7	3.0	3.3	e

# INR HC

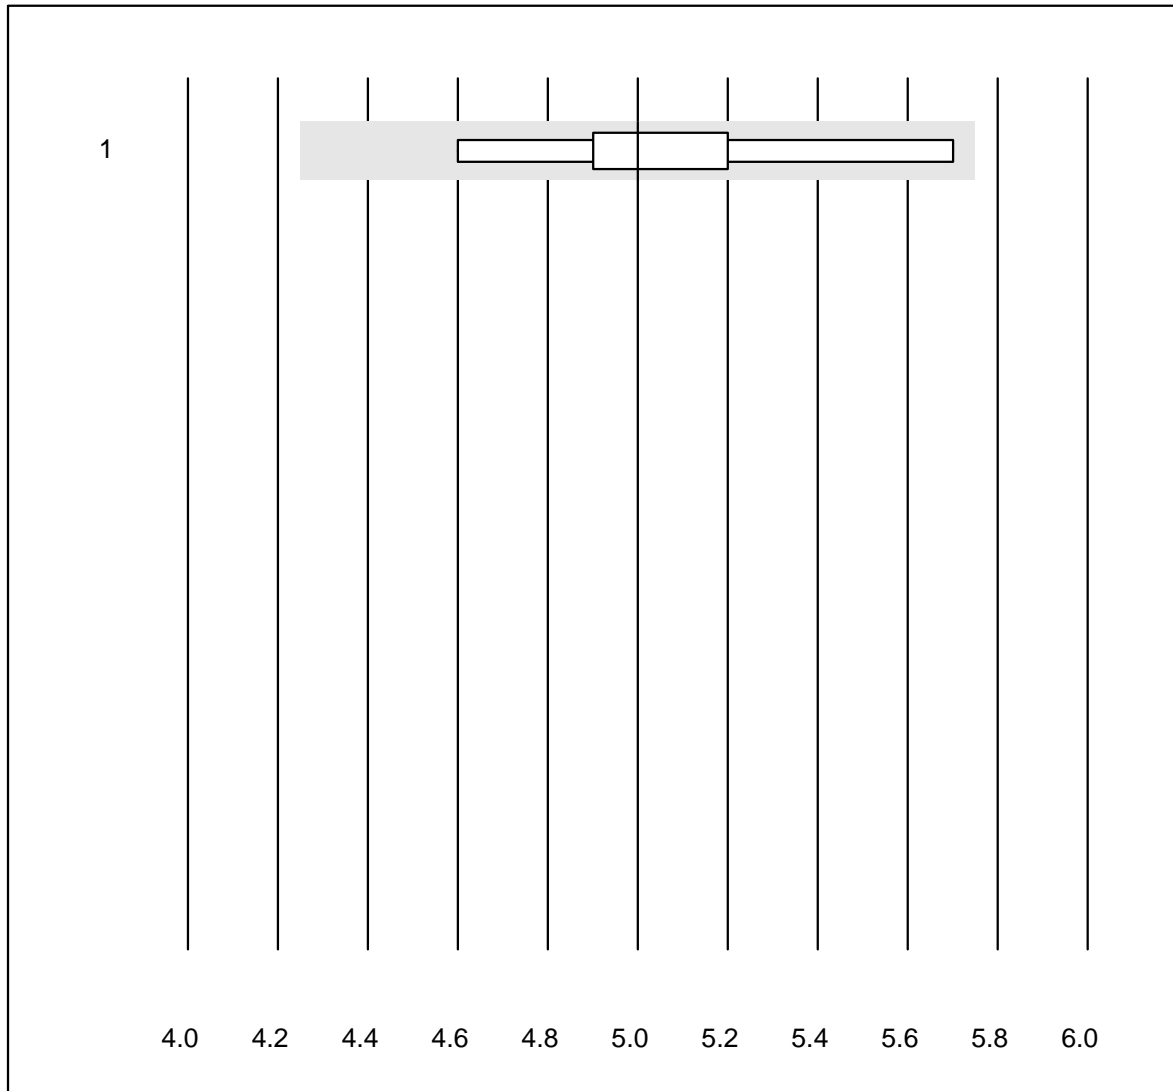


QUALAB Tolérance : 15 %

INR HC ()

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Hemochron j.	8	100.0	0.0	0.0	5.0	6.7	e*

# INR MI

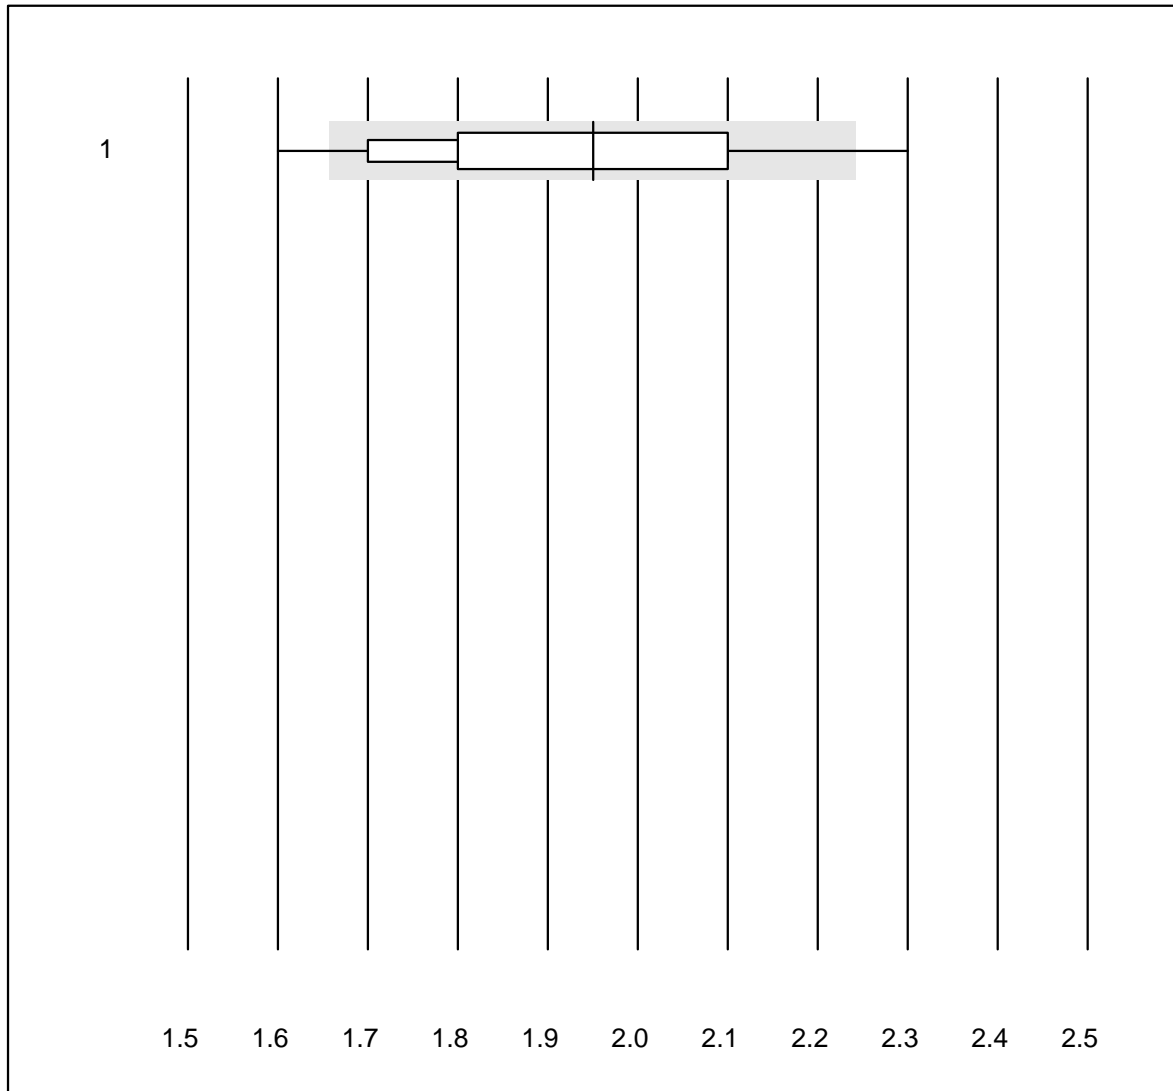


QUALAB Tolérance : 15 %

INR MI ()

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 MicroINR	135	70.3	6.7	23.0	2.0	8.7	e

## INR Xprecia

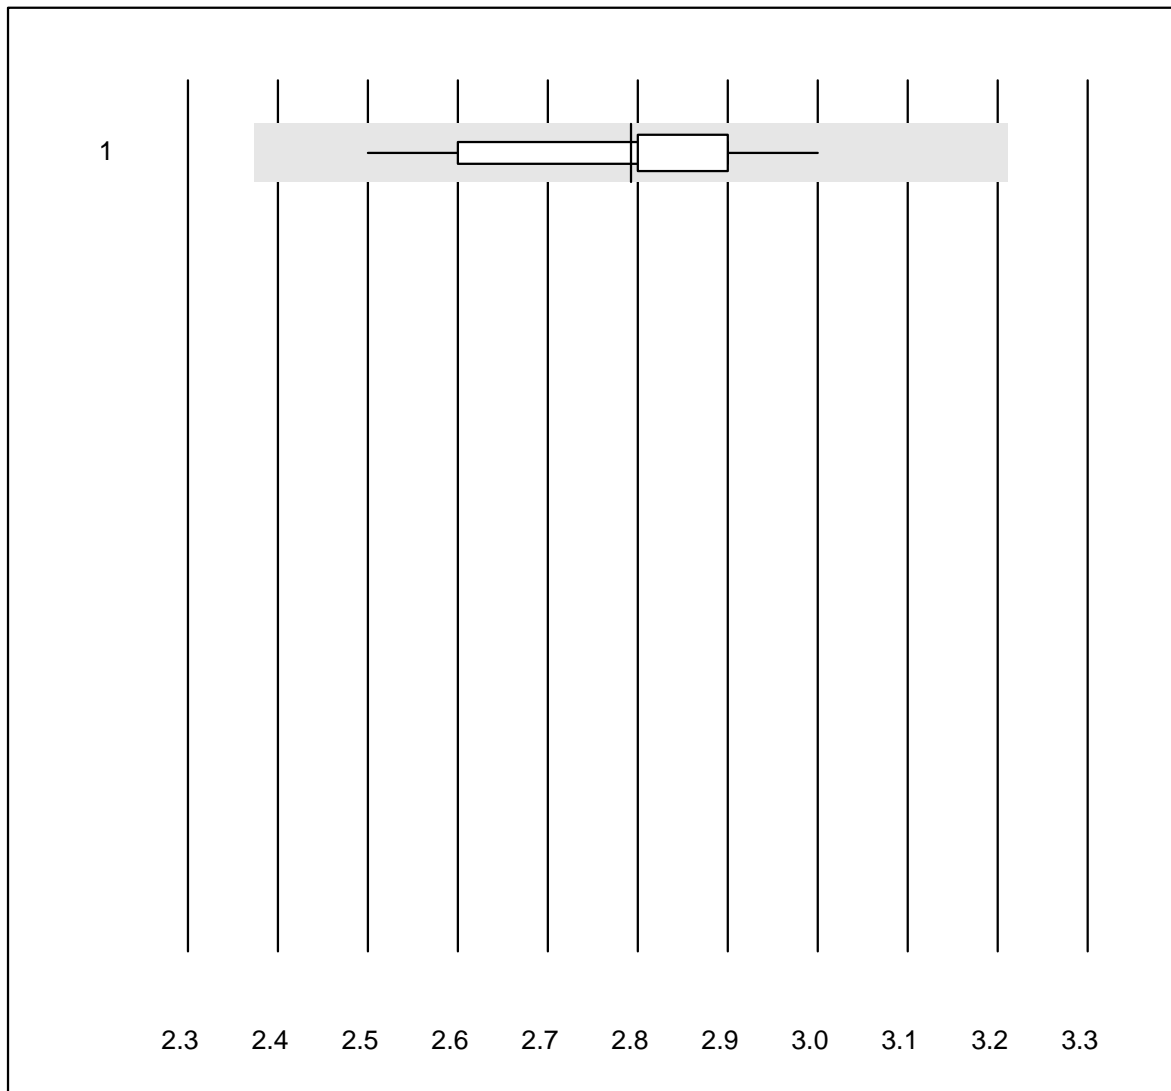


QUALAB Tolérance : 15 %

INR Xprecia ()

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Xprecia	58	98.3	0.0	1.7	2.8	4.4	e

## INR Lumira Dx

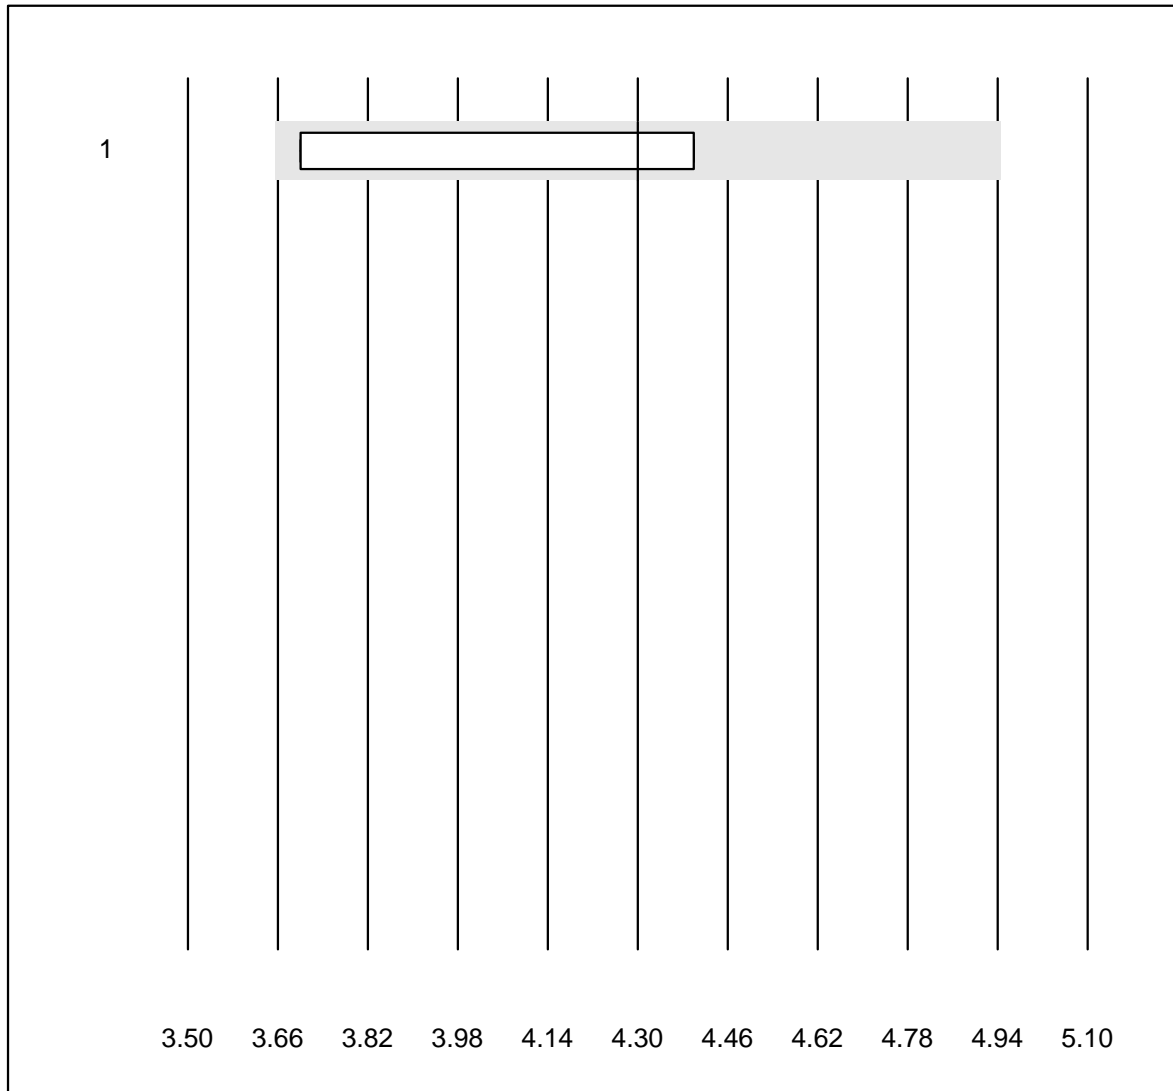


QUALAB Tolérance : 15 %

INR Lumira Dx ()

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Lumira Dx	4	100.0	0.0	0.0	4.3	7.9	e*



## Anti-FXa (LMW-Heparin)

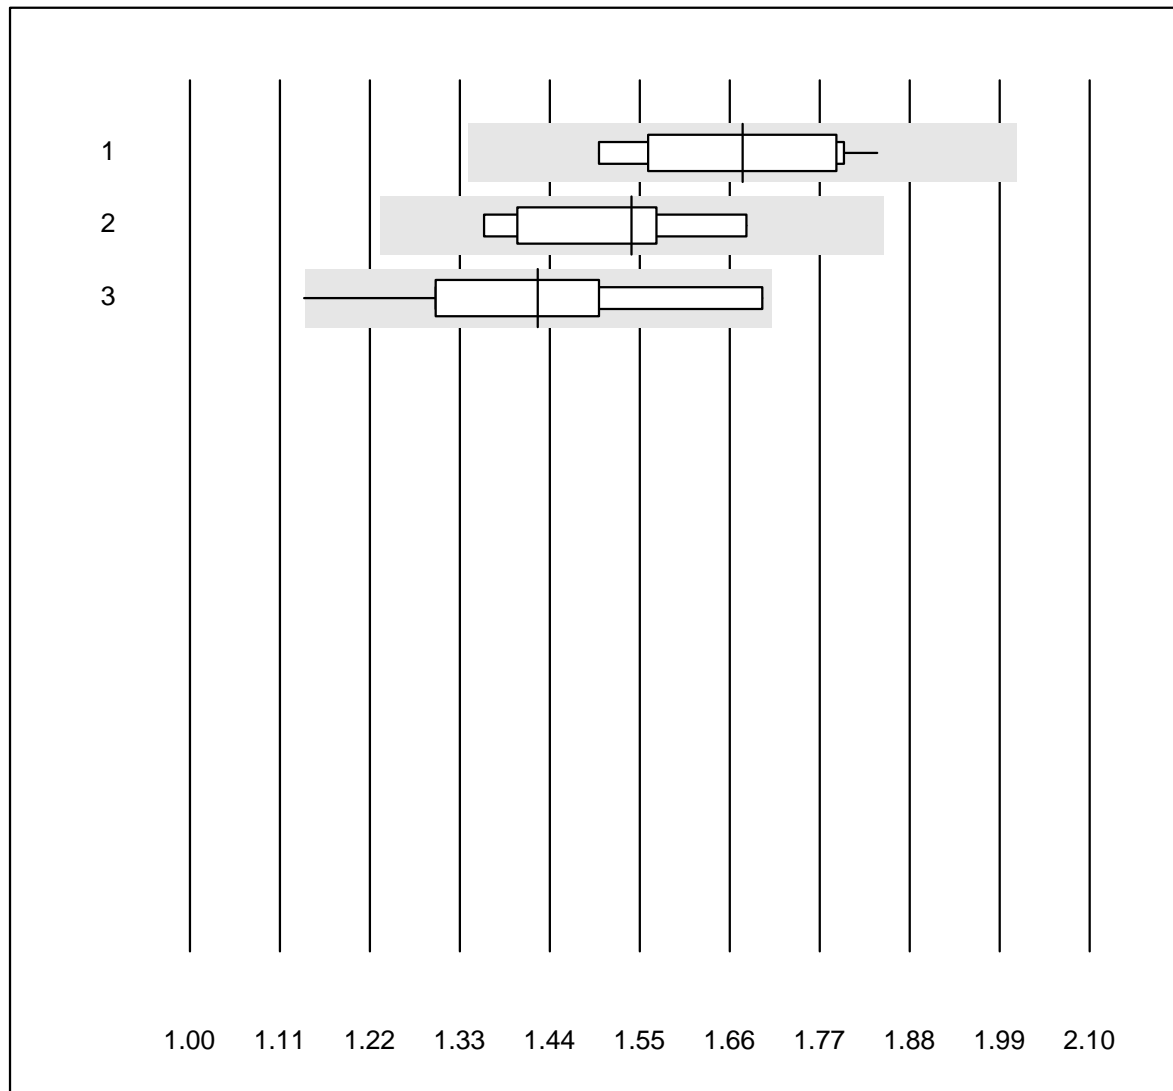


Tolérance MQ : 20 %

Anti-FXa (LMW-Heparin) (IU/ml)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	11	100.0	0.0	0.0	1.68	7.4	e
2 Stago/STA	8	100.0	0.0	0.0	1.54	7.3	e*
3 ACL	13	92.3	7.7	0.0	1.43	11.4	e*

## Anti-FXa (Rivaroxaban)

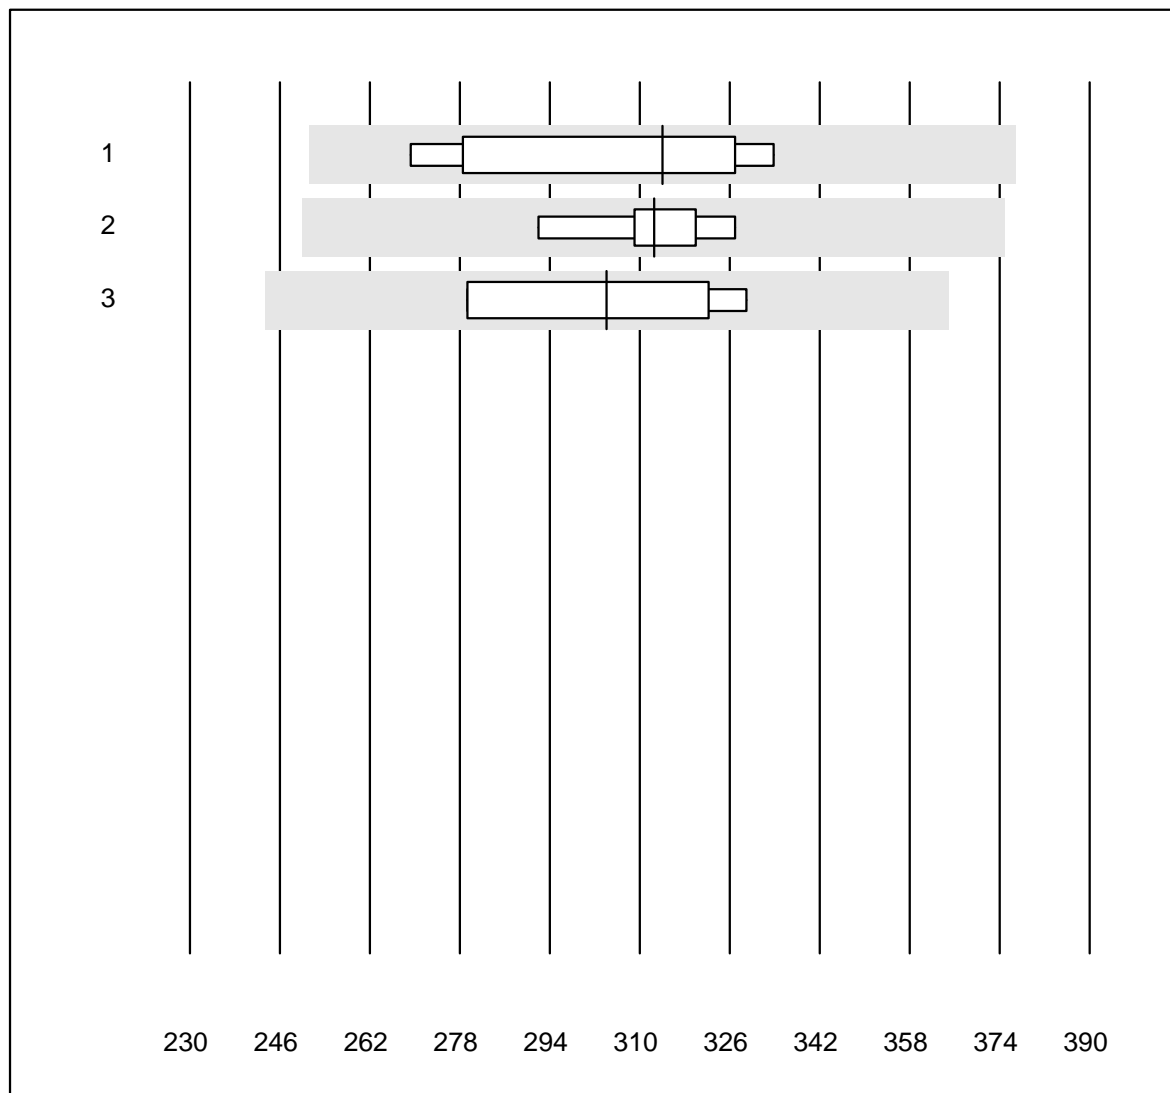


Tolérance MQ : 20 %

Anti-FXa (Rivaroxaban) (µg/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	314.00	8.1	e*
2 Stago/STA	8	87.5	0.0	12.5	312.50	3.5	e
3 ACL	4	100.0	0.0	0.0	304.10	8.2	e*

## Anti-FXa (Apixaban)

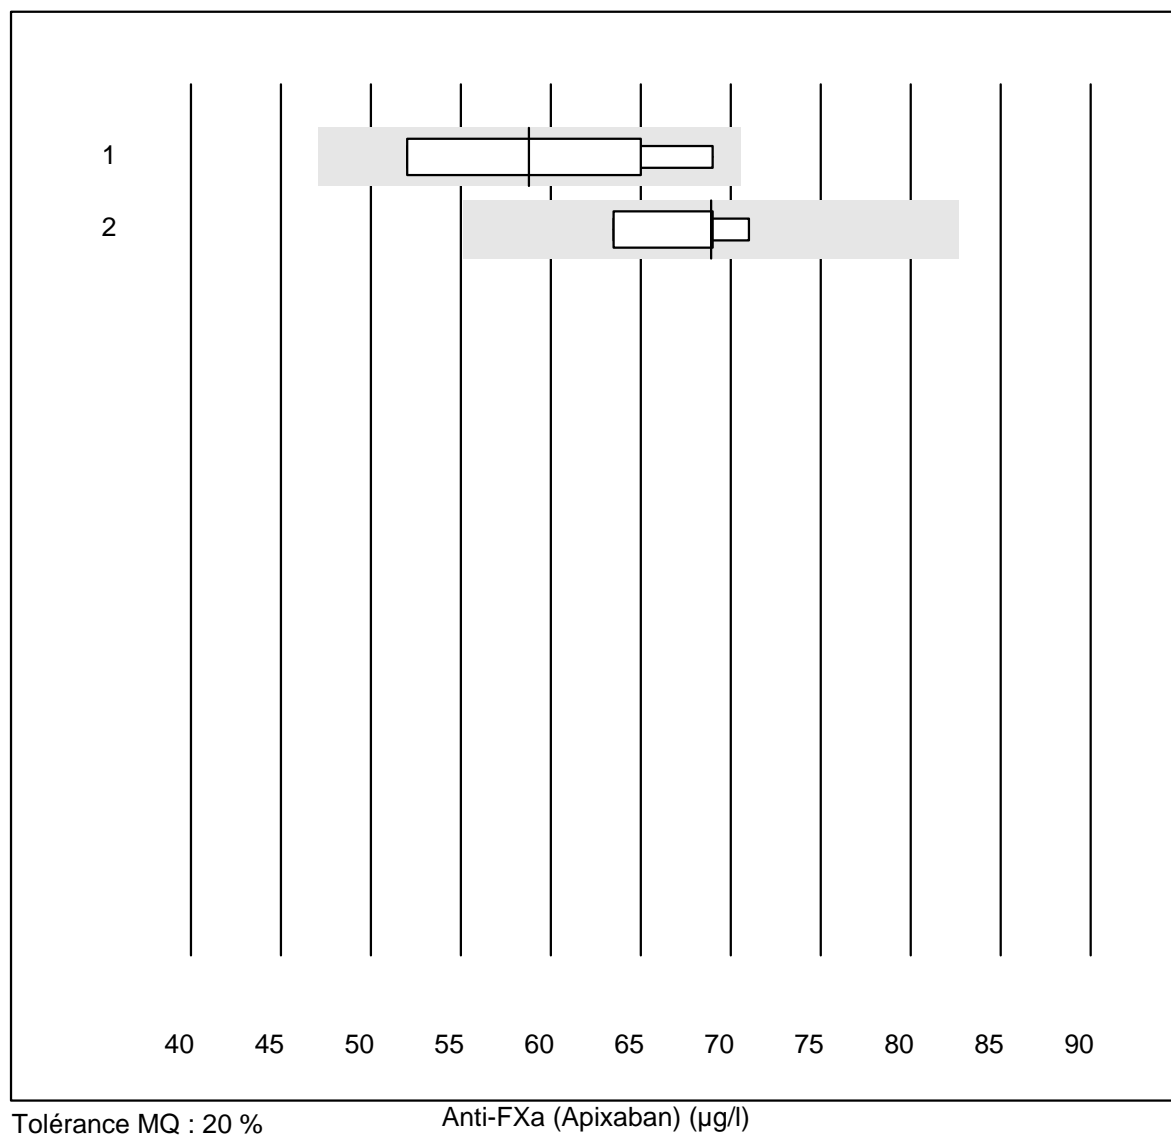


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	58.80	14.5	e*
2 ACL	4	100.0	0.0	0.0	68.90	4.7	e

## Hémoglobine

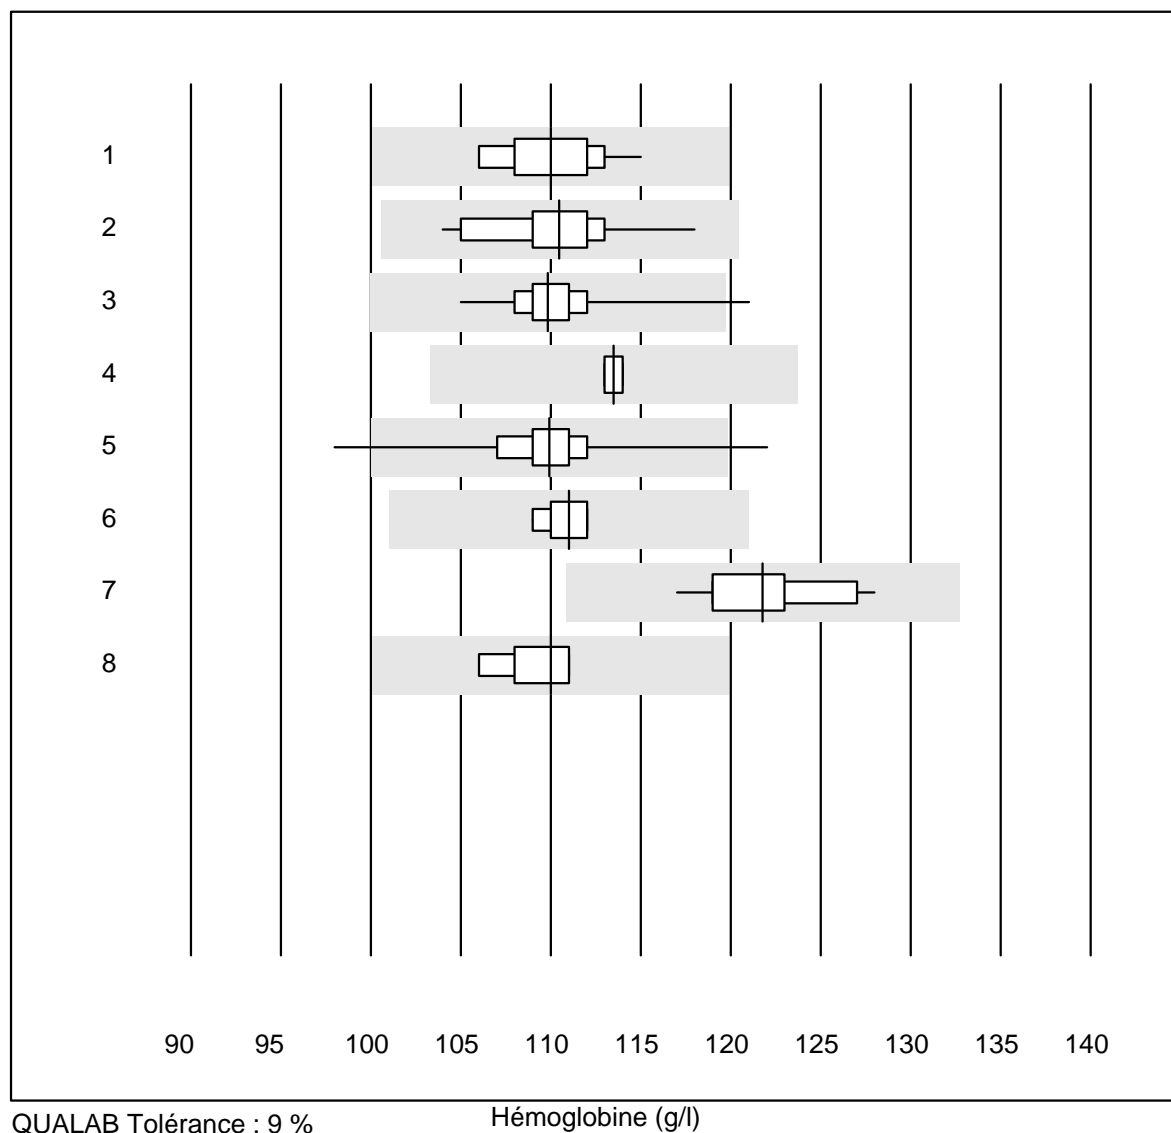


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Automate	17	94.1	0.0	5.9	110.0	2.3	e
2 Cyanmethémoglobine	20	85.0	0.0	15.0	110.5	2.9	e
3 Sysmex X	45	97.8	2.2	0.0	109.8	2.1	e
4 Advia 120	4	100.0	0.0	0.0	113.5	0.5	e
5 Hemocue	406	95.3	2.0	2.7	109.9	2.5	e
6 Hemocontrol	9	100.0	0.0	0.0	111.0	1.0	e
7 DiaSpect	15	93.3	0.0	6.7	121.8	2.5	e
8 Sysmex	9	100.0	0.0	0.0	110.0	1.7	e

## Hémoglobine

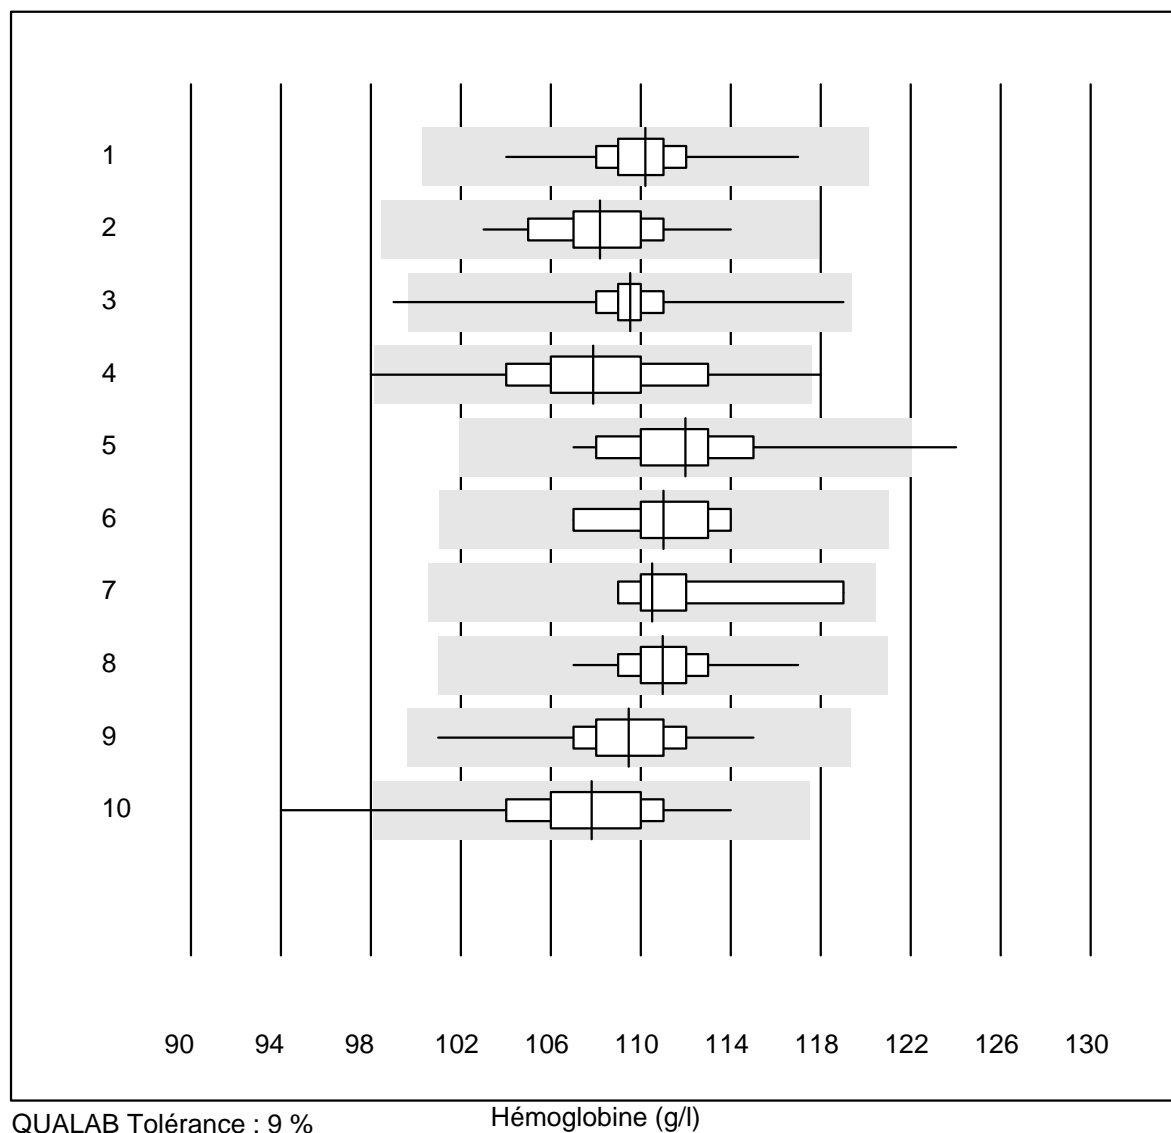

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex KX21	194	96.9	0.0	3.1	110.2	1.5	e
2 Sysmex PochH - 100i	200	99.0	0.0	1.0	108.2	2.1	e
3 Sysmex XP 300	618	97.2	0.2	2.6	109.5	1.5	e
4 Mythic	265	96.6	1.5	1.9	107.9	3.1	e
5 Swelab	32	96.9	3.1	0.0	112.0	2.9	e
6 Abacus Junior	5	100.0	0.0	0.0	111.0	2.5	e*
7 Medonic	6	100.0	0.0	0.0	110.5	3.3	e*
8 Celltac Alpha (Nihon)	85	95.3	0.0	4.7	111.0	1.7	e
9 Samsung HC10	23	95.7	0.0	4.3	109.5	2.5	e
10 Micros 60	99	98.0	2.0	0.0	107.8	3.0	e

## Hématocrite

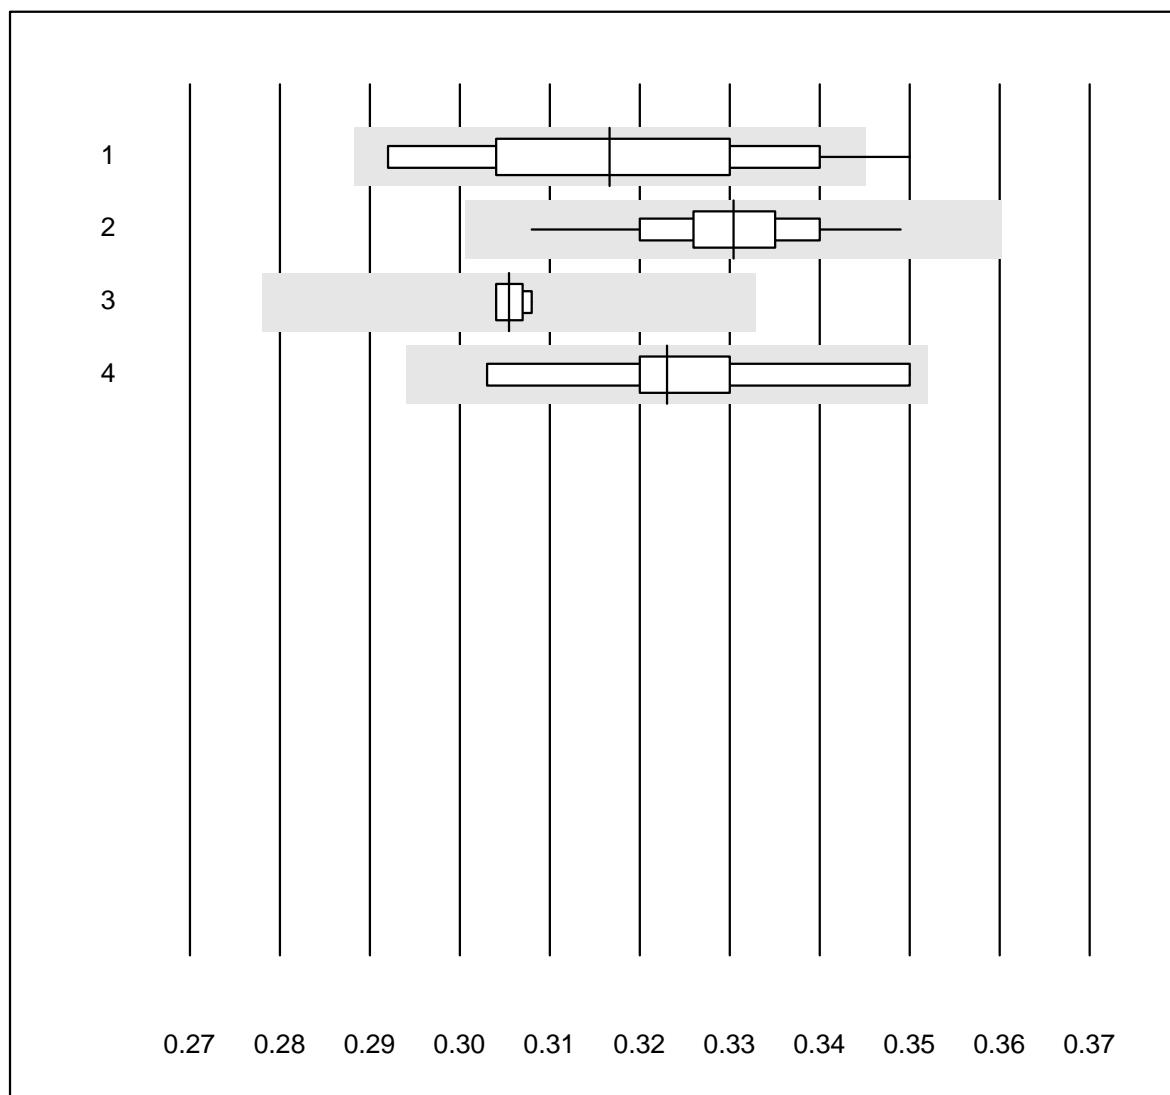


QUALAB Tolérance : 9 %

Hématocrite (l/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Automate	17	94.1	5.9	0.0	0.32	5.6	e*
2 Sysmex X	45	97.8	0.0	2.2	0.33	2.3	e
3 Advia 120	4	100.0	0.0	0.0	0.31	0.7	e
4 Sysmex	9	100.0	0.0	0.0	0.32	4.4	e*

## Hématocrite

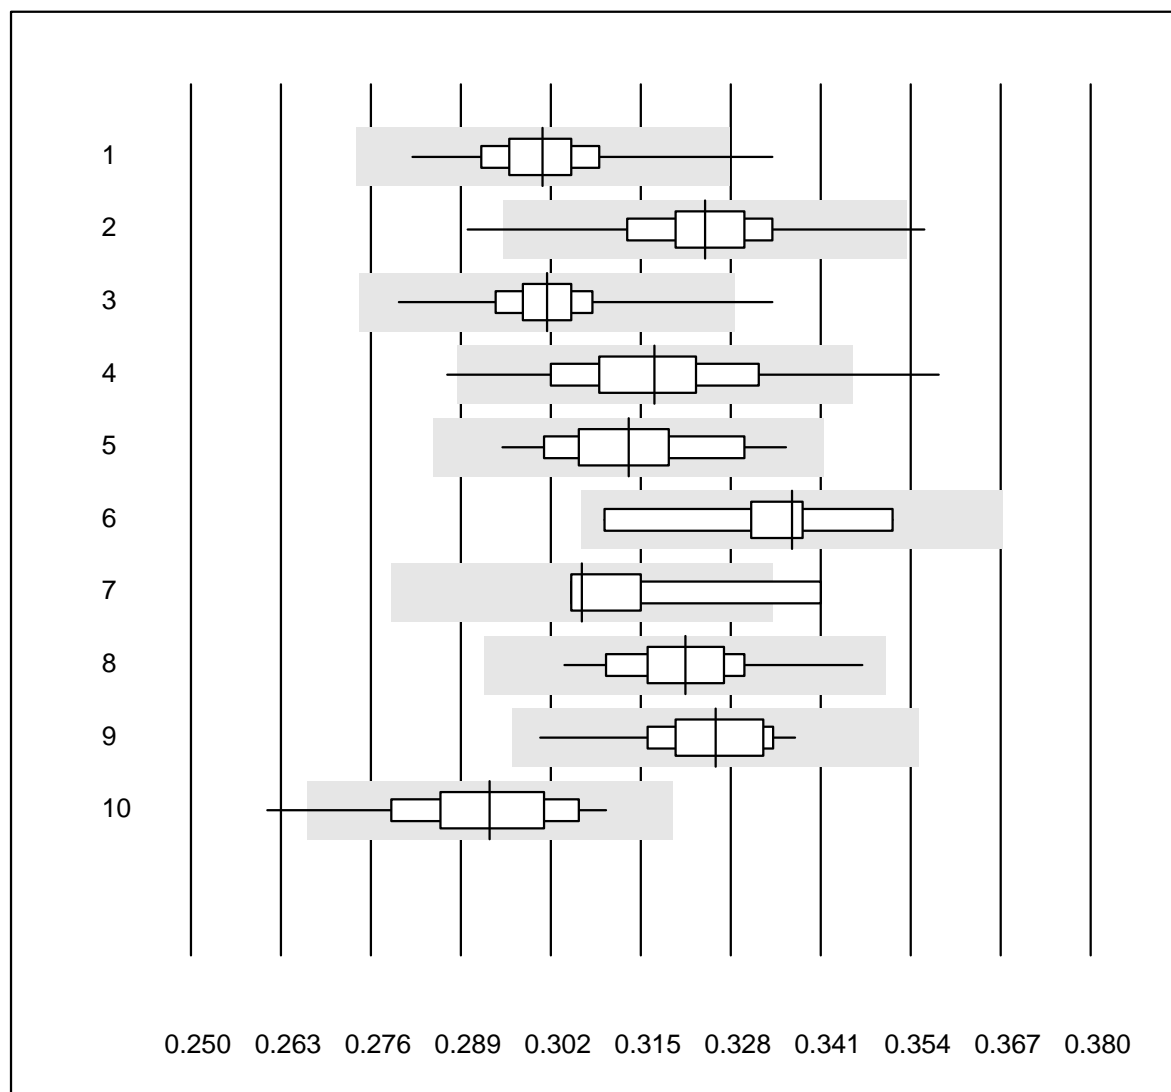


QUALAB Tolérance : 9 %

Hématocrite (l/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex KX21	194	97.5	1.0	1.5	0.30	2.4	e
2 Sysmex PochH - 100i	200	98.0	1.5	0.5	0.32	2.8	e
3 Sysmex XP 300	619	97.7	0.5	1.8	0.30	2.0	e
4 Mythic	266	95.9	1.5	2.6	0.32	3.6	e
5 Swelab	32	100.0	0.0	0.0	0.31	3.4	e
6 Abacus Junior	5	100.0	0.0	0.0	0.34	4.6	e*
7 Medonic	6	83.3	16.7	0.0	0.31	4.5	e*
8 Celltac Alpha (Nihon)	85	94.1	0.0	5.9	0.32	2.5	e
9 Samsung HC10	23	100.0	0.0	0.0	0.33	2.6	e
10 Micros 60	98	97.0	1.0	2.0	0.29	3.6	e

# Erythrocytes

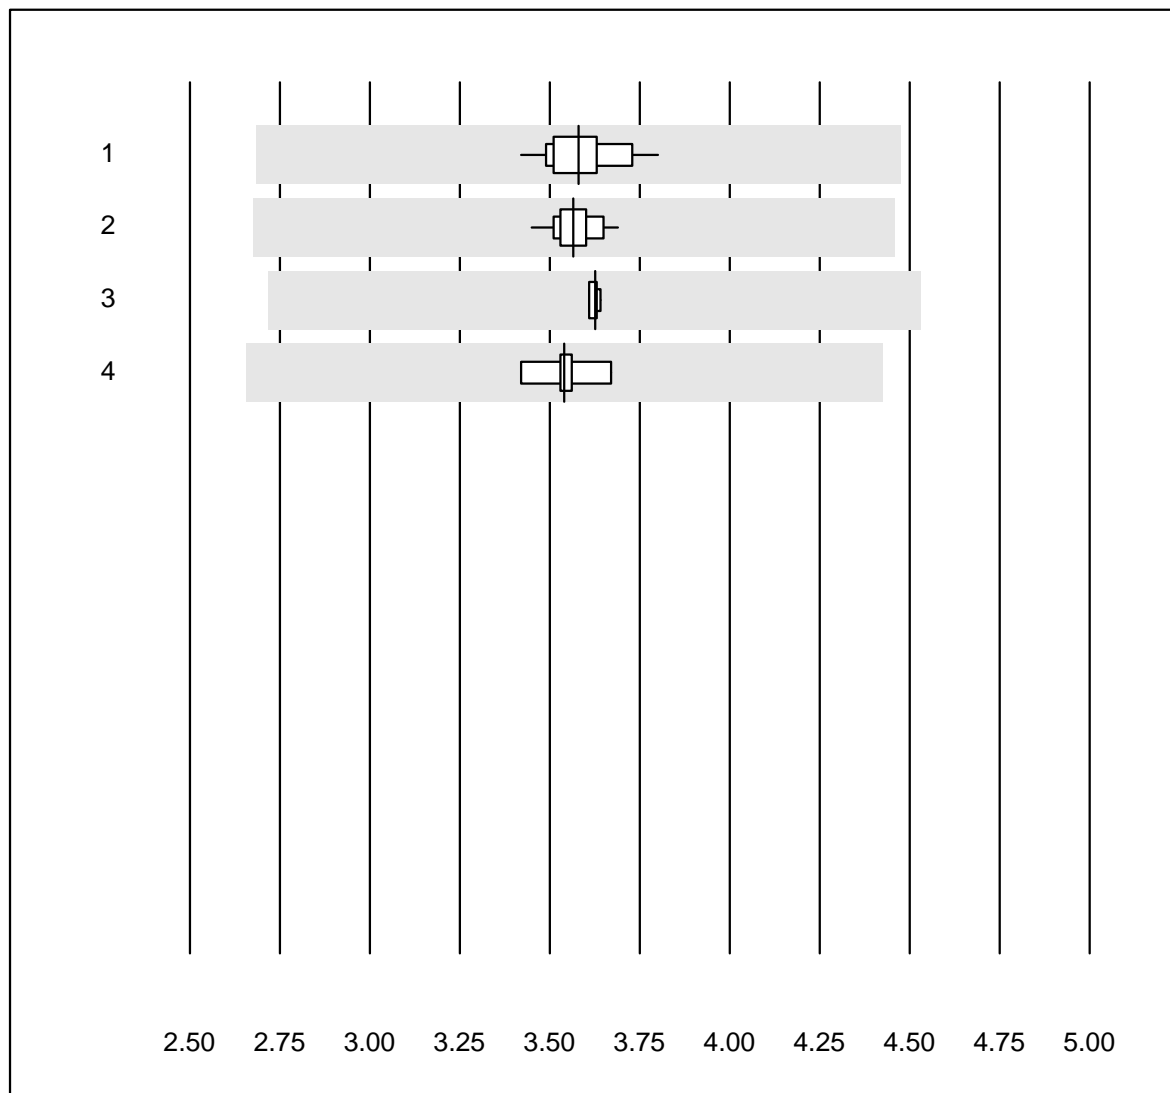


QUALAB Tolérance : 25 %

Erythrocytes (T/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Automate	15	100.0	0.0	0.0	3.58	2.8	e
2 Sysmex X	45	97.8	0.0	2.2	3.57	1.5	e
3 Advia 120	4	100.0	0.0	0.0	3.63	0.4	e
4 Sysmex	9	100.0	0.0	0.0	3.54	2.1	e



## Erythrocytes

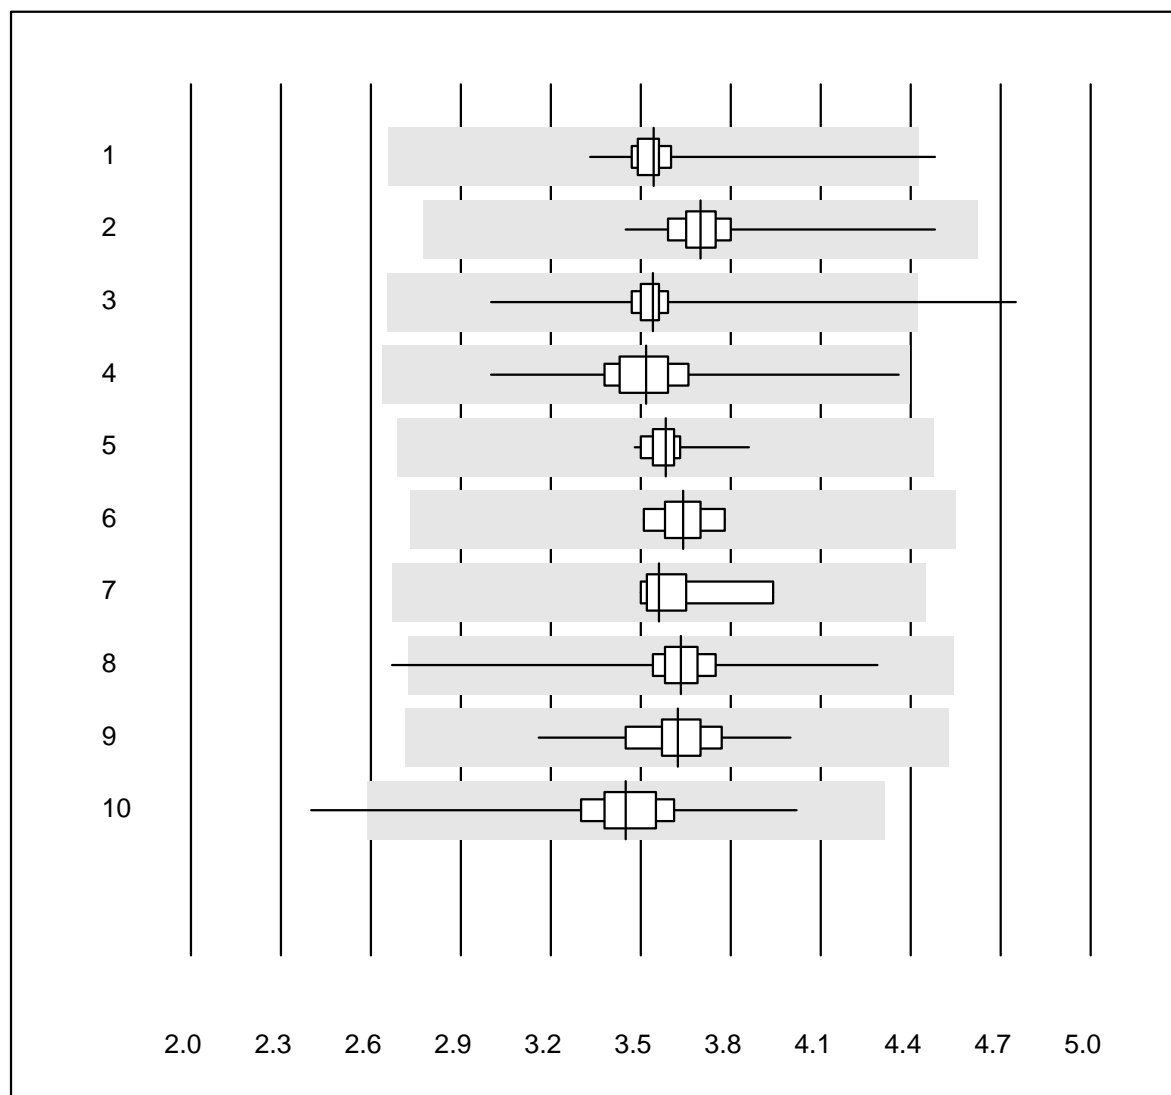


QUALAB Tolérance : 25 %

Erythrocytes (T/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	Sysmex KX21	194	99.0	1.0	0.0	3.54	3.4	e
2	Sysmex PochH - 100i	200	100.0	0.0	0.0	3.70	2.7	e
3	Sysmex XP 300	617	98.3	0.6	1.1	3.54	3.6	e
4	Mythic	266	98.9	0.0	1.1	3.52	3.9	e
5	Swelab	31	100.0	0.0	0.0	3.58	2.1	e
6	Abacus Junior	5	100.0	0.0	0.0	3.64	2.9	e
7	Medonic	6	100.0	0.0	0.0	3.56	4.6	e
8	Celltac Alpha (Nihon	85	96.4	1.2	2.4	3.63	4.4	e
9	Samsung HC10	23	100.0	0.0	0.0	3.62	4.4	e
10	Micros 60	99	98.0	1.0	1.0	3.45	5.4	e

## Leucocytes

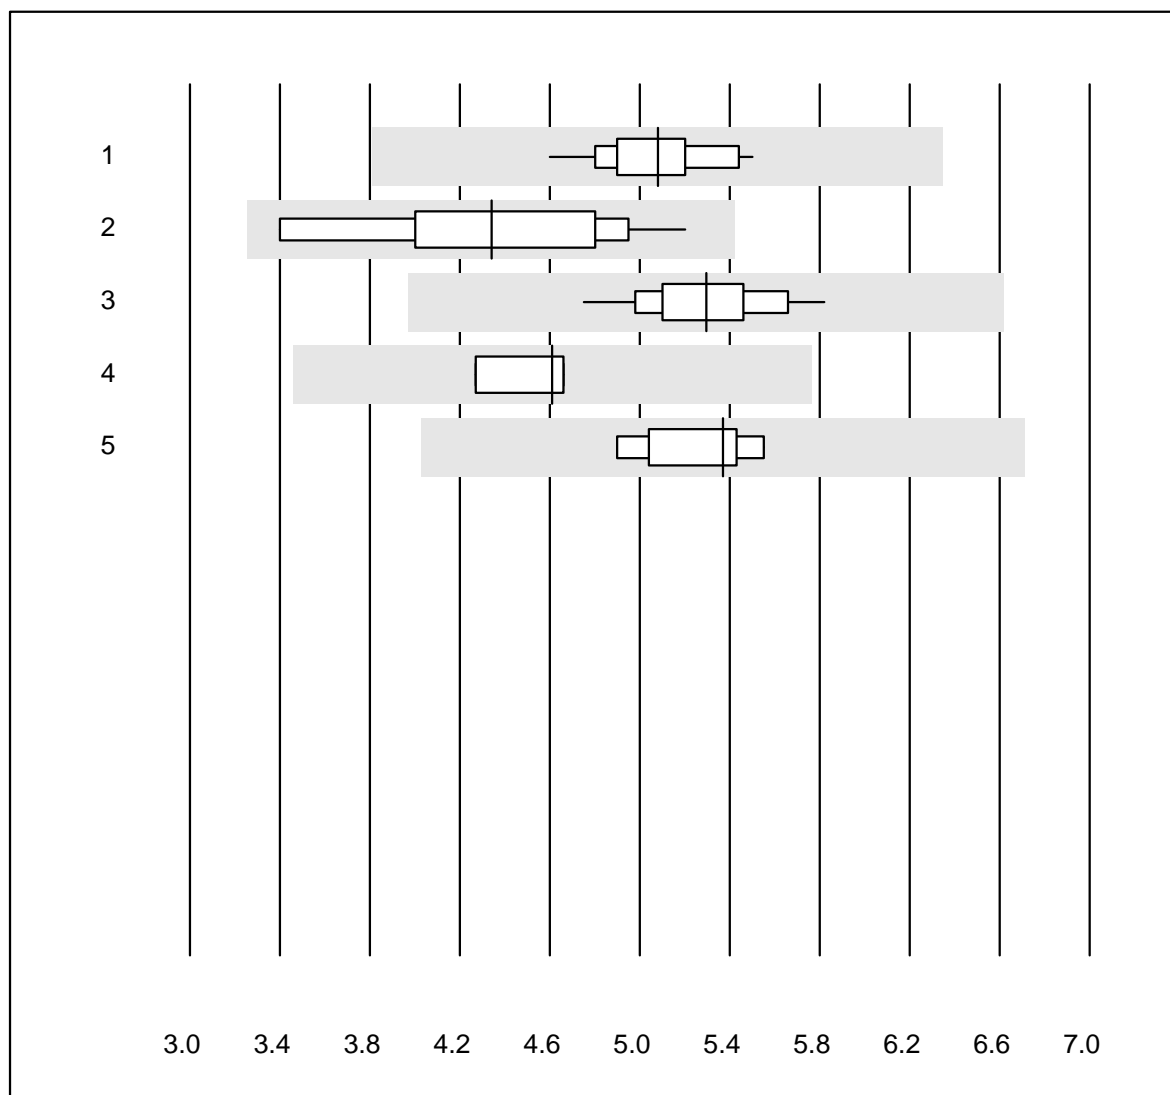


QUALAB Tolérance : 25 %

Leucocytes (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Automate	14	100.0	0.0	0.0	5.08	4.7	e
2 Microscopie	11	90.9	0.0	9.1	4.34	12.5	e*
3 Sysmex X	45	100.0	0.0	0.0	5.30	4.9	e
4 Advia 120 (Perox)	4	75.0	0.0	25.0	4.61	4.5	e
5 Sysmex	9	100.0	0.0	0.0	5.37	4.4	e

## Leucocytes

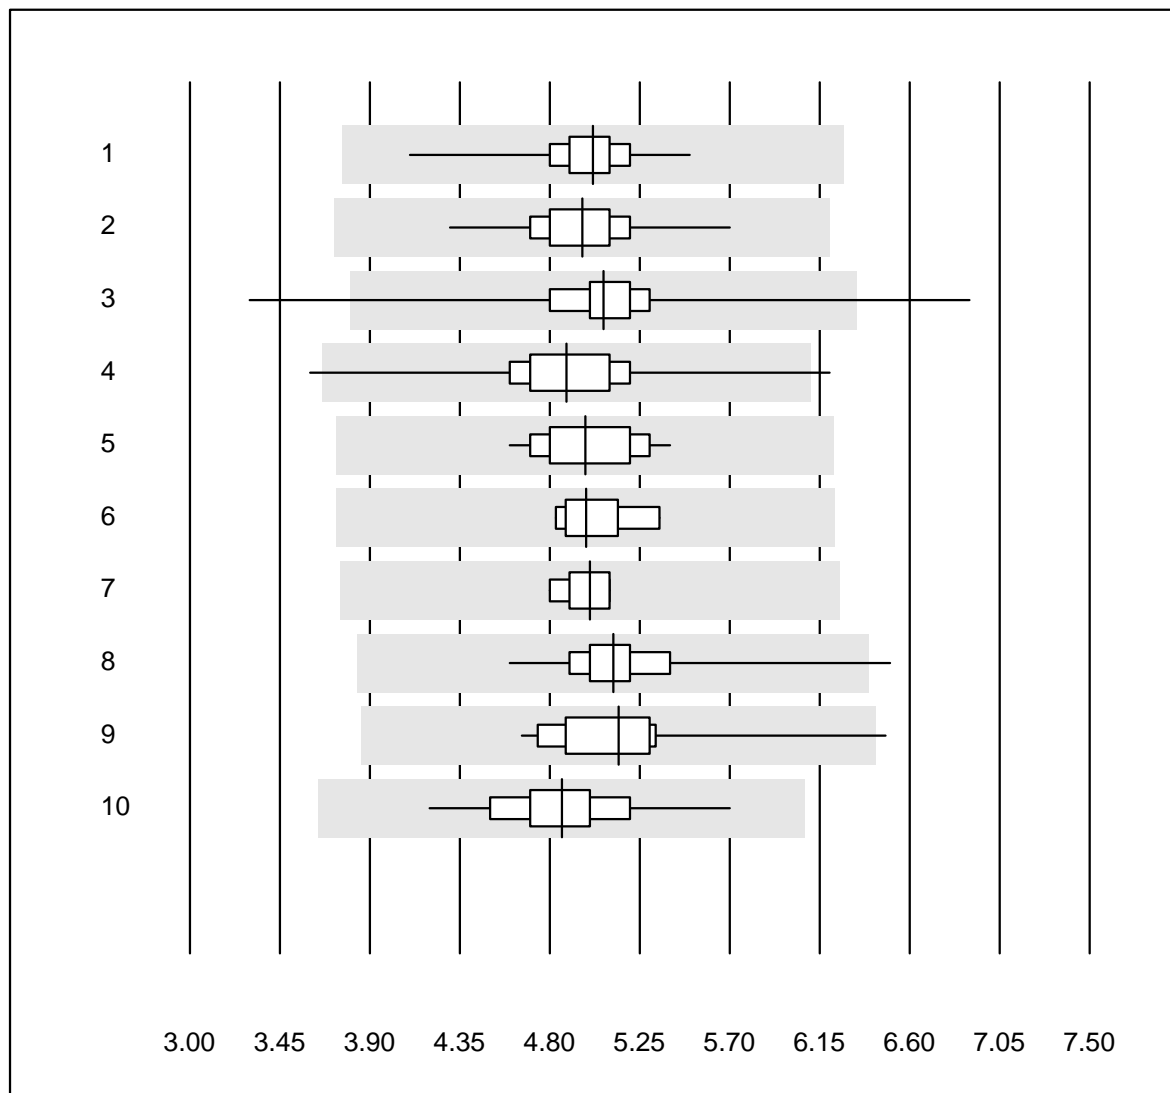


QUALAB Tolérance : 25 %

Leucocytes (G/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	Sysmex KX21	193	100.0	0.0	0.0	5.02	3.9	e
2	Sysmex PochH - 100i	199	100.0	0.0	0.0	4.96	4.1	e
3	Sysmex XP 300	617	99.0	0.5	0.5	5.07	4.5	e
4	Mythic	264	98.4	0.8	0.8	4.88	5.8	e
5	Swelab	32	100.0	0.0	0.0	4.98	4.9	e
6	Abacus Junior	5	100.0	0.0	0.0	4.98	4.2	e
7	Medonic	6	100.0	0.0	0.0	5.00	2.3	e
8	Celltac Alpha (Nihon	85	98.8	1.2	0.0	5.12	5.2	e
9	Samsung HC10	23	95.7	4.3	0.0	5.14	7.1	e
10	Micros 60	99	100.0	0.0	0.0	4.86	5.5	e

## Thrombocytes

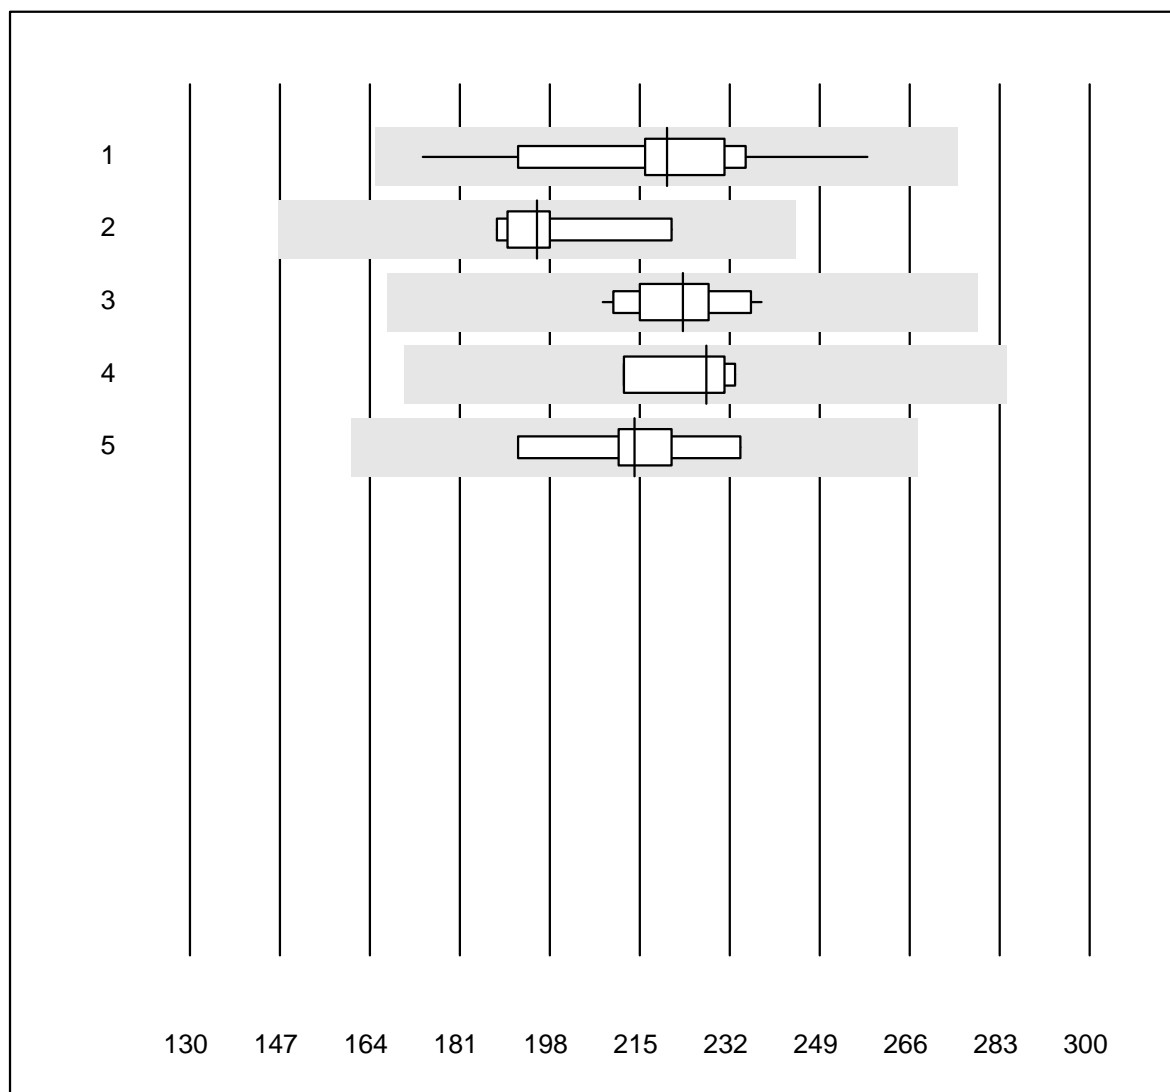


QUALAB Tolérance : 25 %

Thrombocytes (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Automate	14	92.9	0.0	7.1	220.1	10.1	e
2 Microscopie	6	100.0	0.0	0.0	195.5	6.0	e
3 Sysmex X	45	100.0	0.0	0.0	223.1	3.8	e
4 Advia 120	4	100.0	0.0	0.0	227.5	4.2	e
5 Sysmex	9	100.0	0.0	0.0	214.0	5.9	e

## Thrombocytes

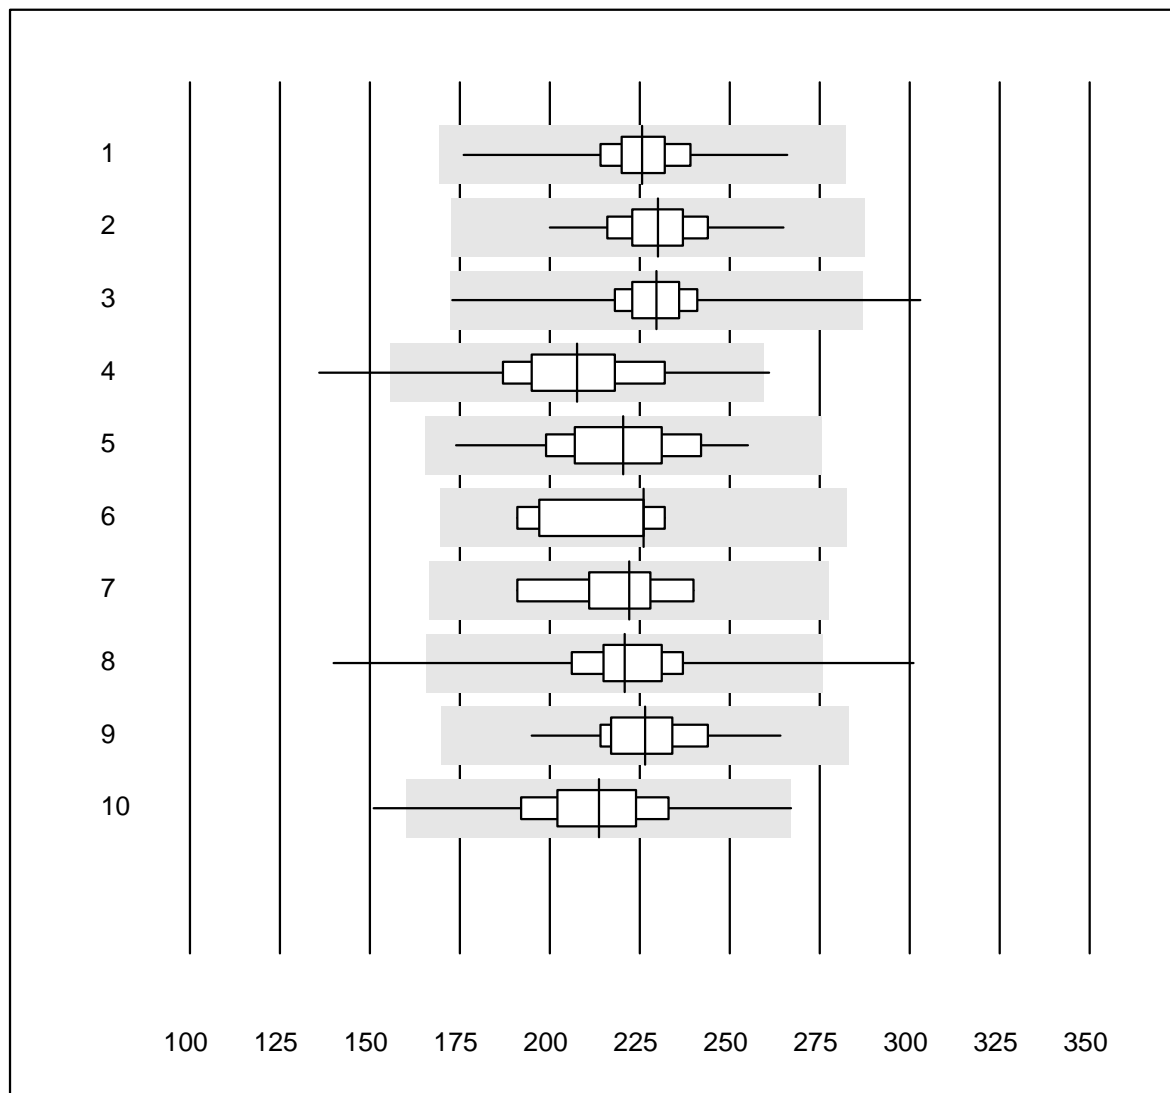


QUALAB Tolérance : 25 %

Thrombocytes (G/l)


No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	Sysmex KX21	193	98.4	0.0	1.6	225.7	4.7	e
2	Sysmex PochH - 100i	199	99.5	0.0	0.5	229.9	4.7	e
3	Sysmex XP 300	617	99.3	0.2	0.5	229.6	4.7	e
4	Mythic	265	98.8	0.8	0.4	207.5	9.0	e
5	Swelab	32	100.0	0.0	0.0	220.4	7.8	e
6	Abacus Junior	5	100.0	0.0	0.0	226.0	8.8	e*
7	Medonic	6	100.0	0.0	0.0	222.0	7.7	e*
8	Celltac Alpha (Nihon	85	96.5	3.5	0.0	220.7	8.4	e
9	Samsung HC10	23	95.7	0.0	4.3	226.5	7.0	e
10	Micros 60	99	98.0	2.0	0.0	213.6	8.9	e

## Hémoglobine H2

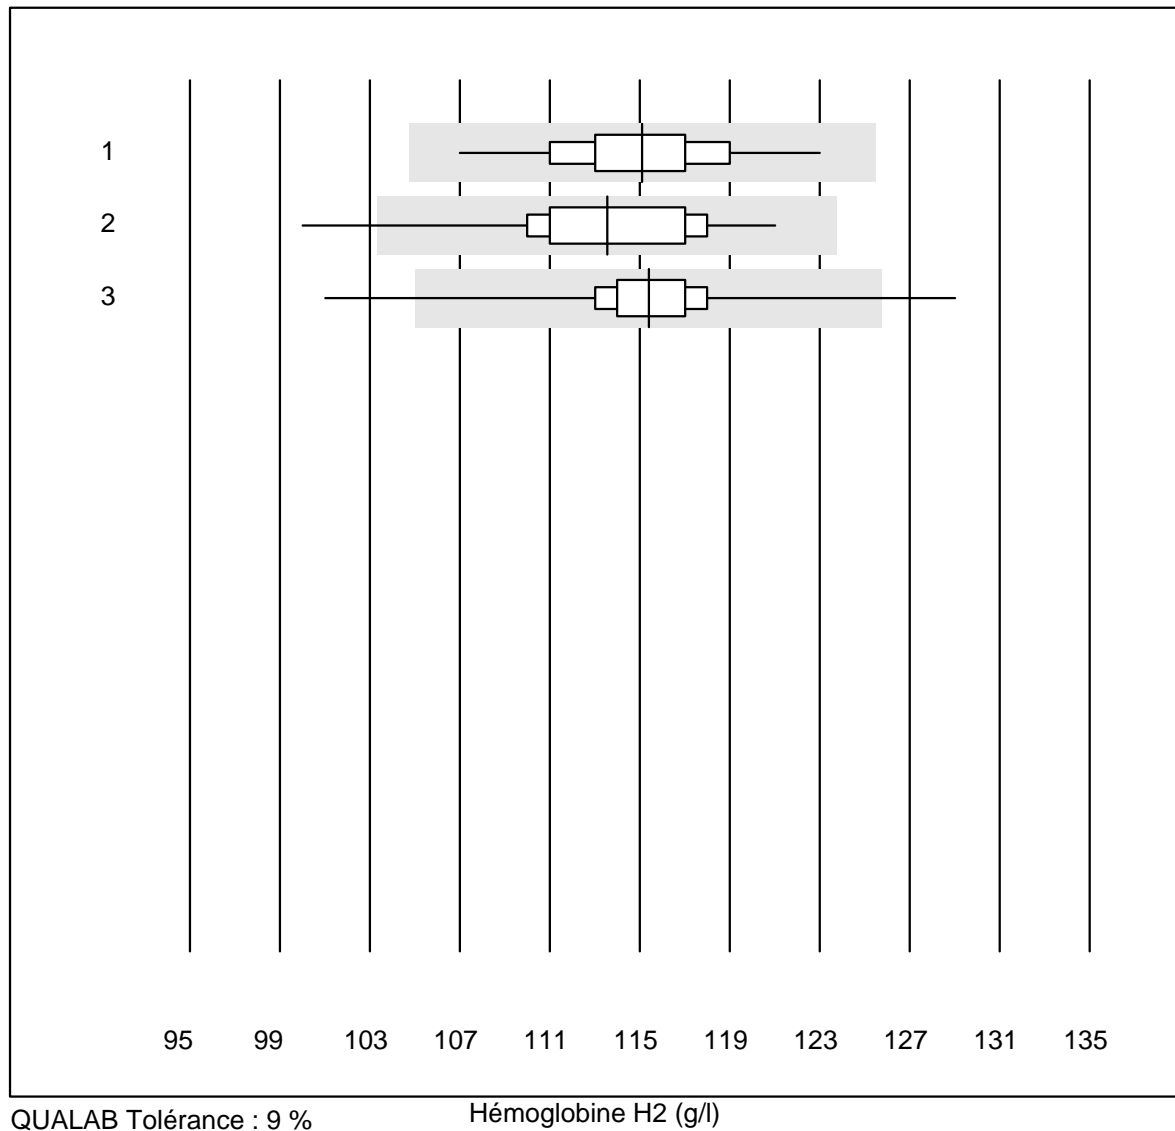

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Z3	133	96.2	0.0	3.8	115.1	2.7	e
2 Abx Micros	80	96.2	2.5	1.3	113.5	3.5	e
3 Microsemi	846	93.0	1.4	5.6	115.4	2.4	e

## Hématocrite H2

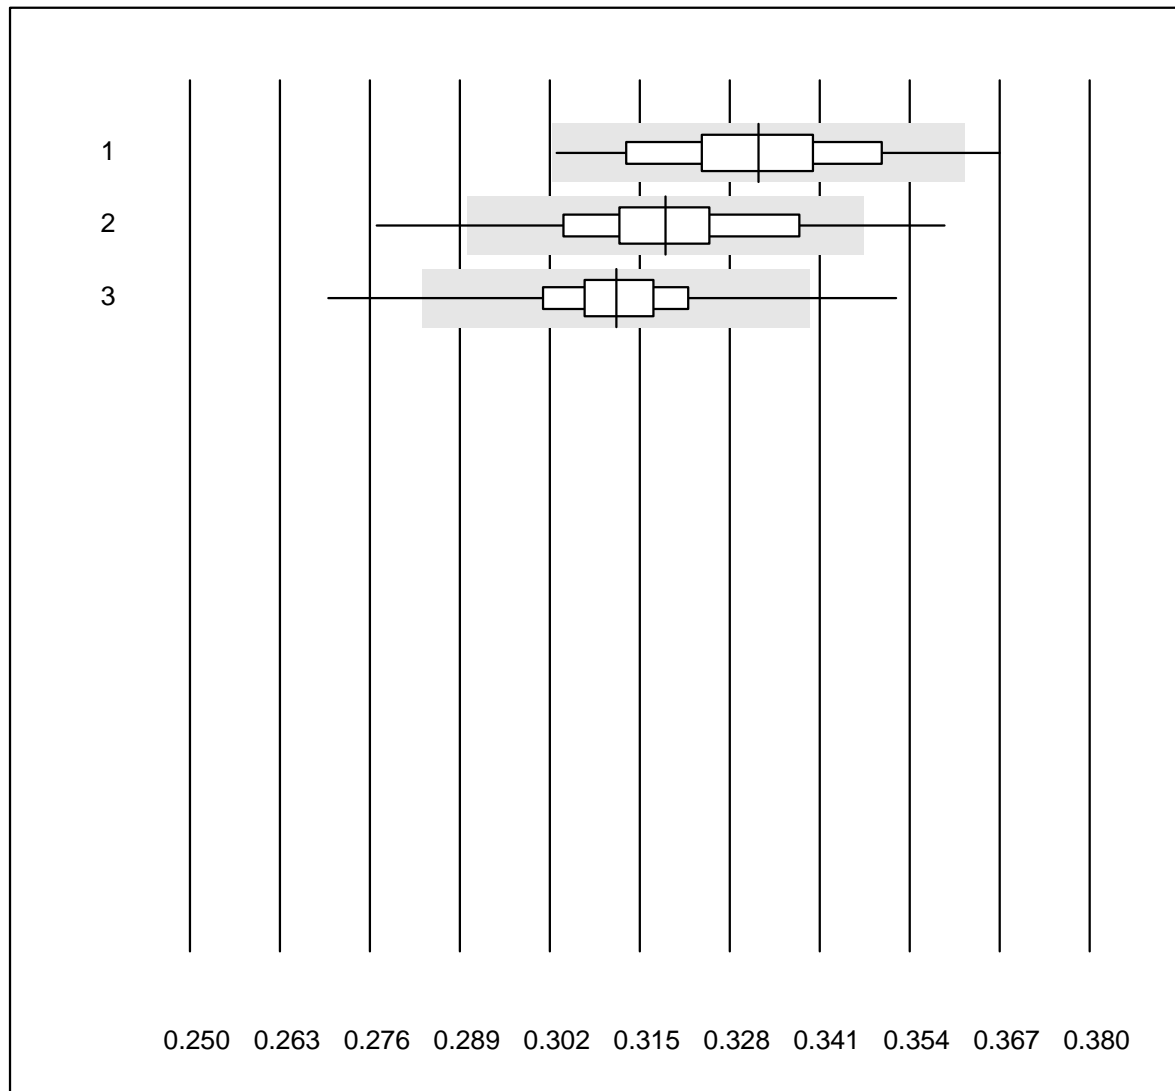


QUALAB Tolérance : 9 %

Hématocrite H2 (l/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Z3	133	95.5	1.5	3.0	0.33	4.0	e
2 Abx Micros	80	93.7	3.8	2.5	0.32	4.2	e
3 Microsemi	846	92.2	1.9	5.9	0.31	3.0	e

## Leucocytes H2

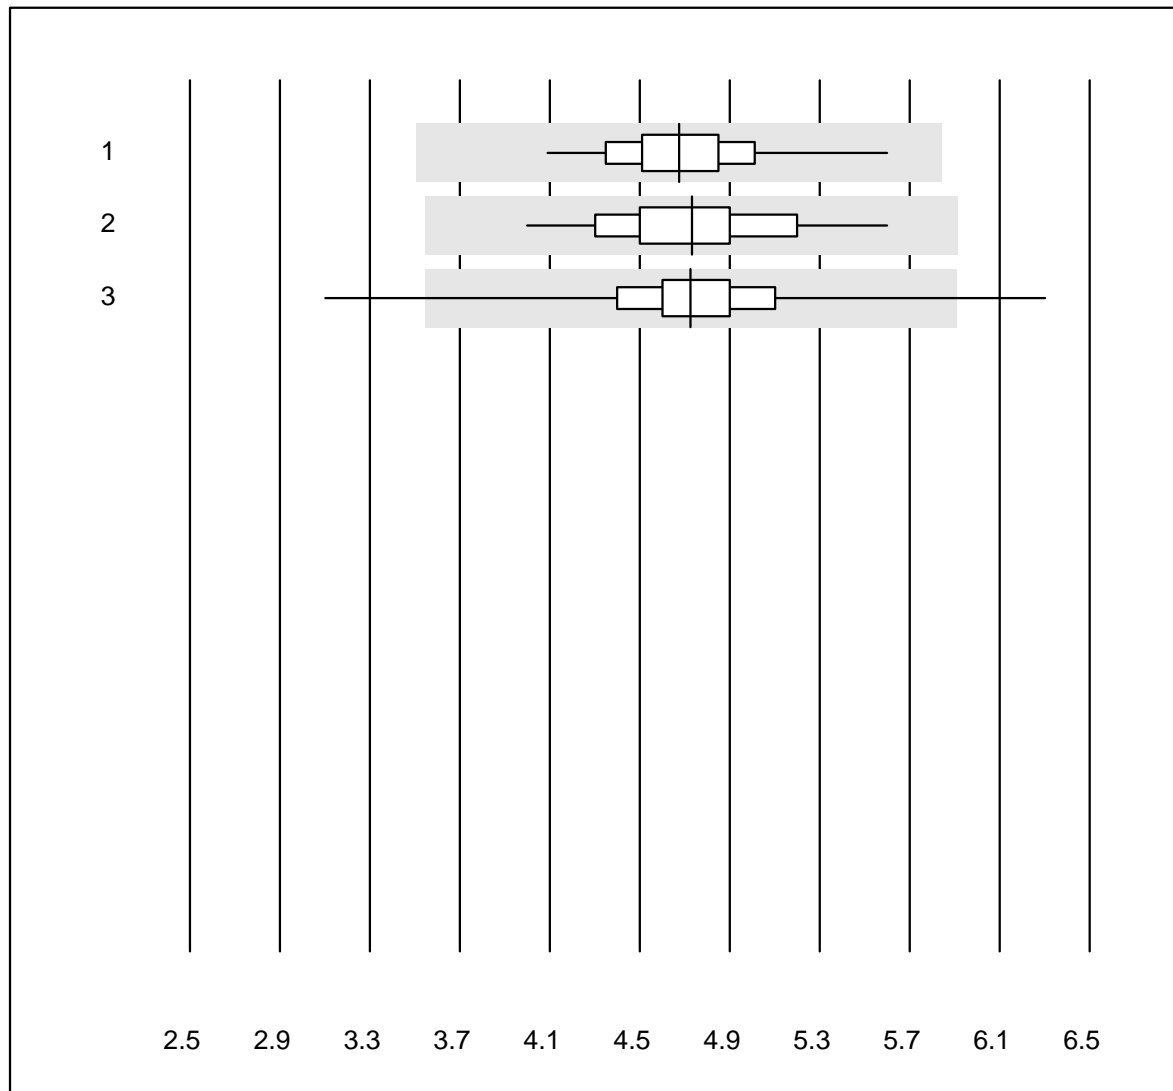


QUALAB Tolérance : 25 %

Leucocytes H2 (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Z3	133	98.5	0.0	1.5	4.67	5.8	e
2 Abx Micros	80	96.2	0.0	3.8	4.73	7.0	e
3 Microsemi	846	98.2	0.6	1.2	4.73	6.7	e



## Thrombocytes H2

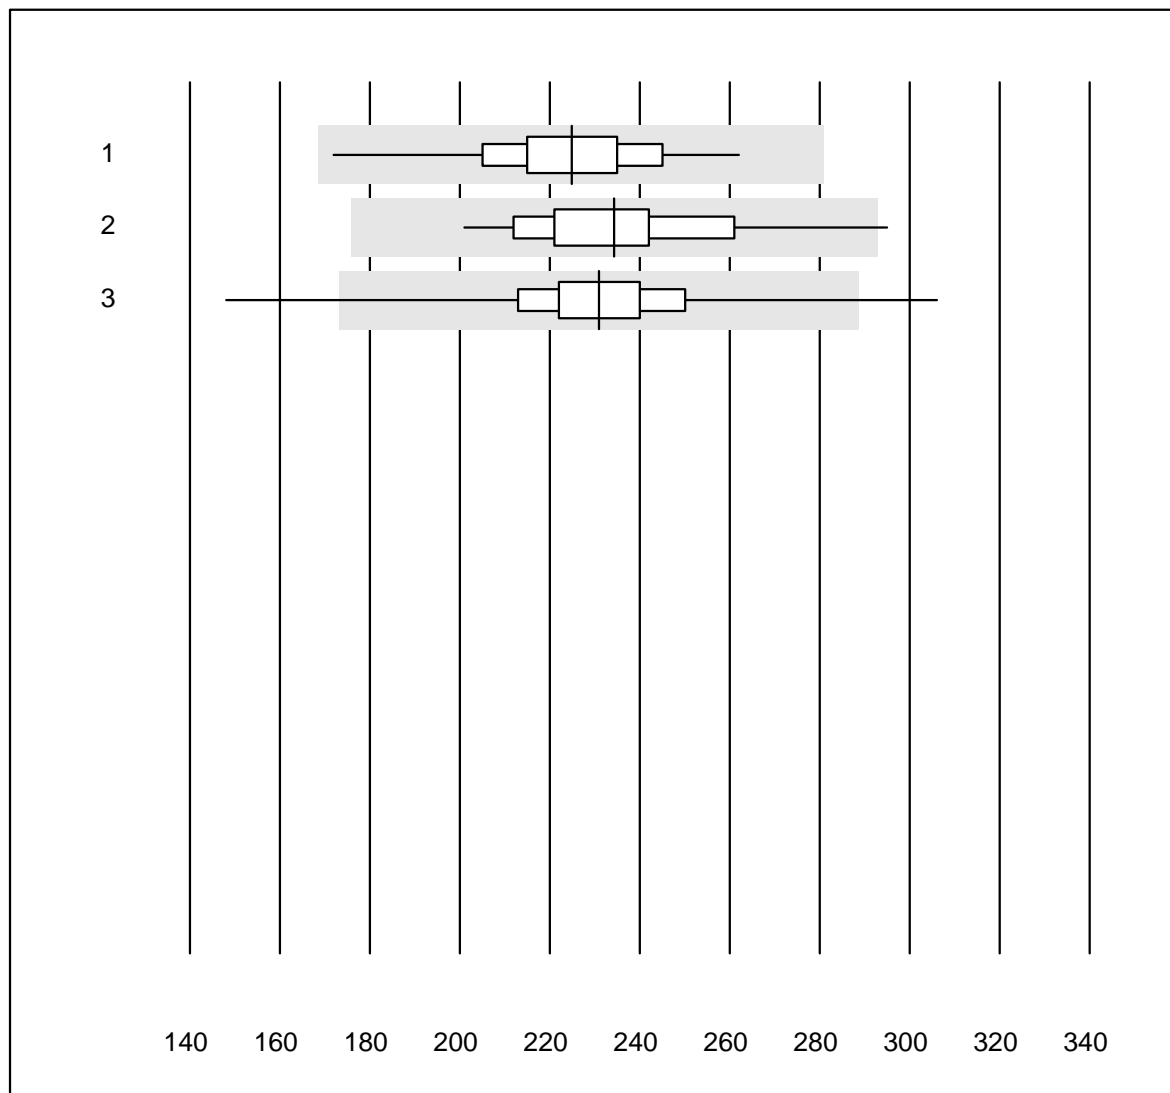


QUALAB Tolérance : 25 %

Thrombocytes H2 (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Z3	133	97.7	0.0	2.3	224.8	7.3	e
2 Abx Micros	80	91.2	1.3	7.5	234.3	8.4	e
3 Microsemi	846	95.9	2.0	2.1	230.9	7.5	e

## Erythrocytes H2

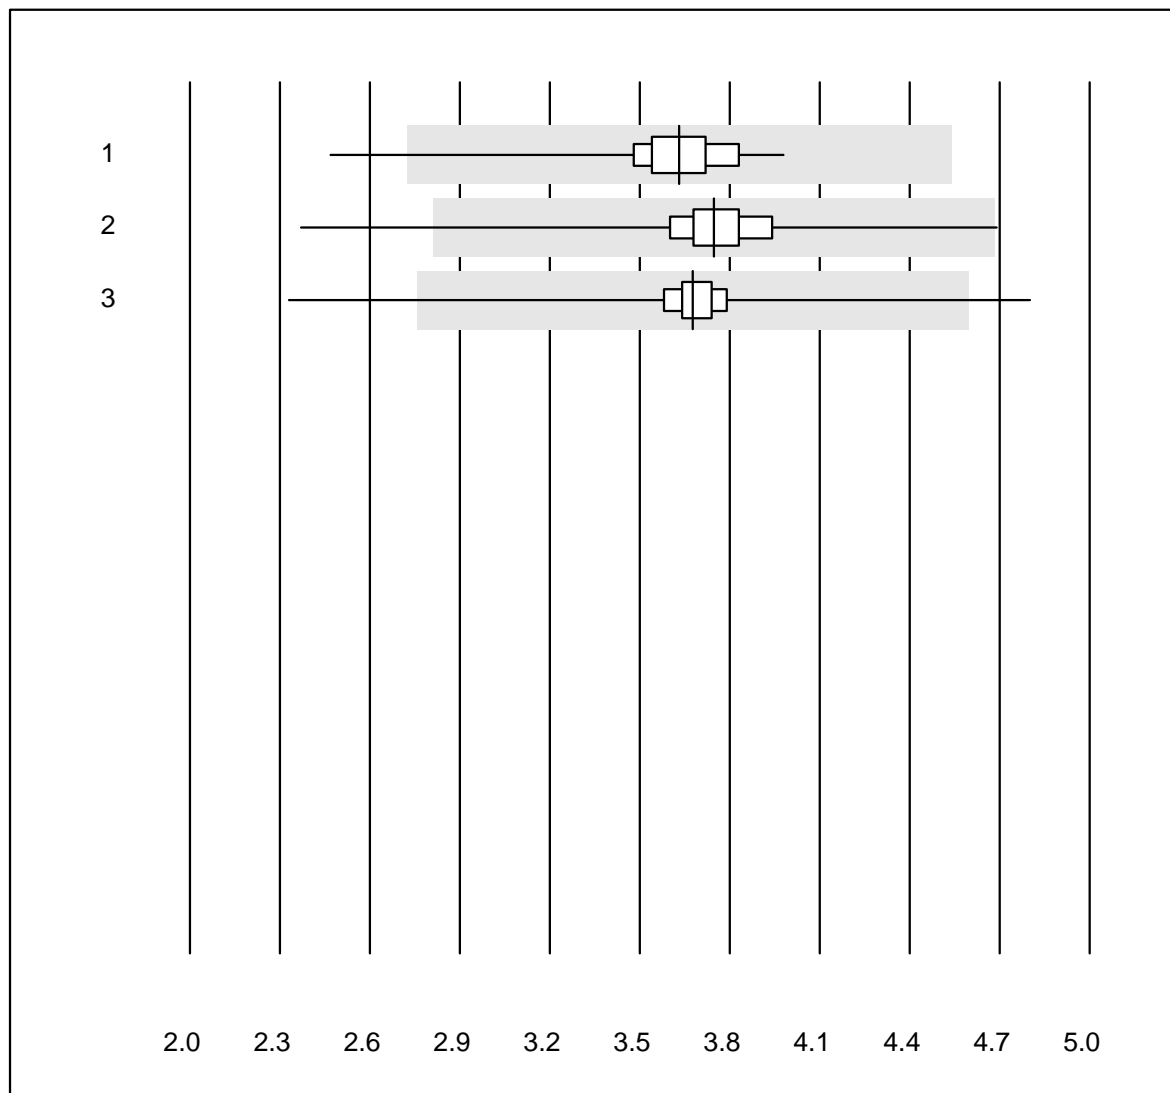


QUALAB Tolérance : 25 %

Erythrocytes H2 (T/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Z3	133	96.9	0.8	2.3	3.63	4.5	e
2 Abx Micros	80	97.5	2.5	0.0	3.75	6.3	e
3 Microsemi	845	95.5	1.5	3.0	3.68	5.3	e

## CRP H2

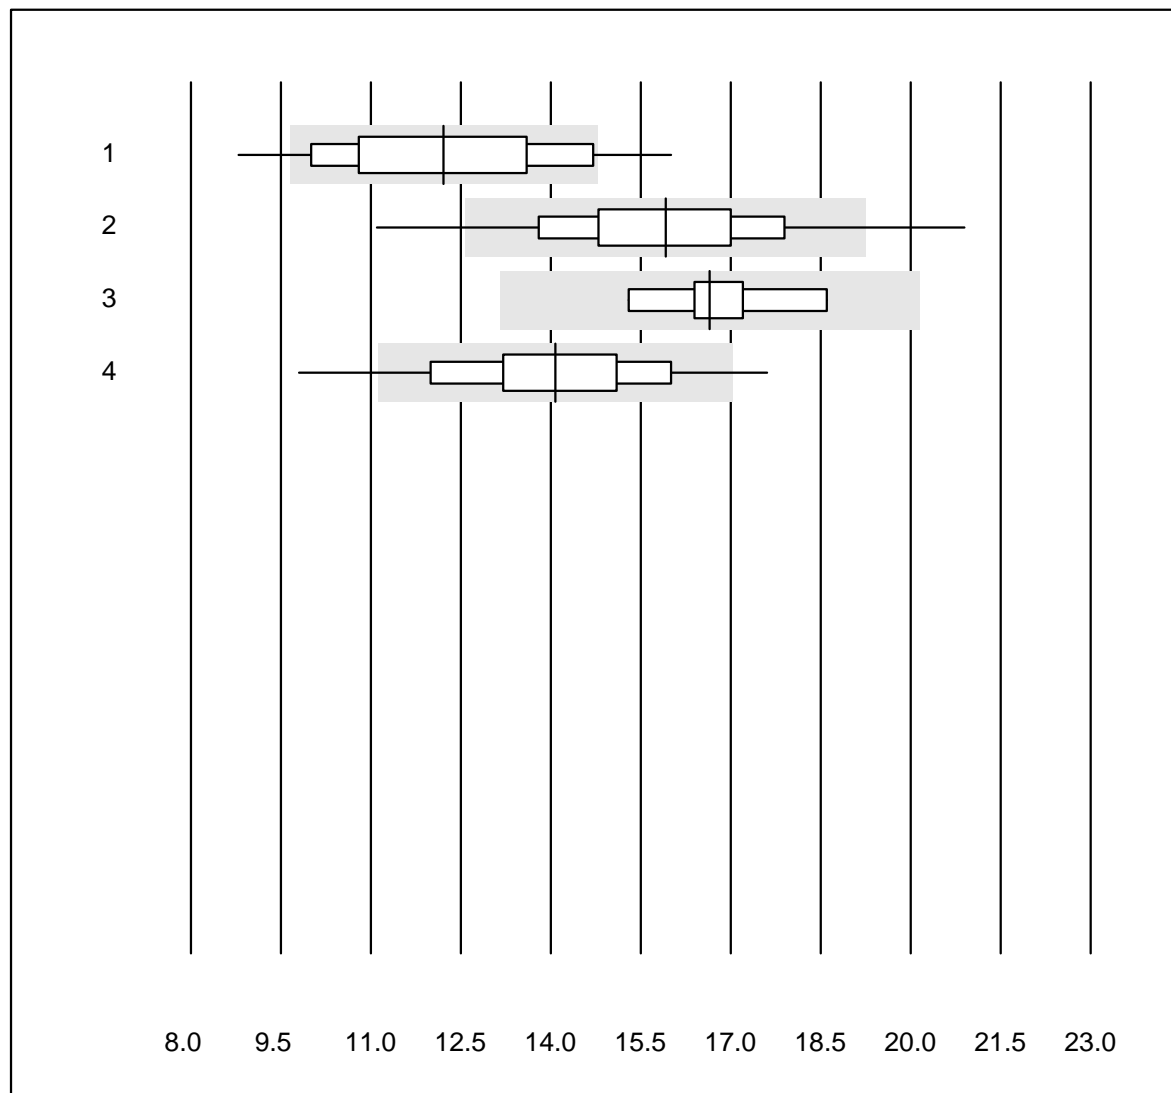


QUALAB Tolérance : 21 %

CRP H2 (mg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Z3	121	85.1	13.2	1.7	12.2	14.4	e
2 Microsemi	833	92.4	3.6	4.0	15.9	10.1	e
3 Abx Micros	8	100.0	0.0	0.0	16.7	5.6	e
4 ABX Micros CRP200	72	84.7	5.6	9.7	14.1	11.2	e

## Hémoglobine BG

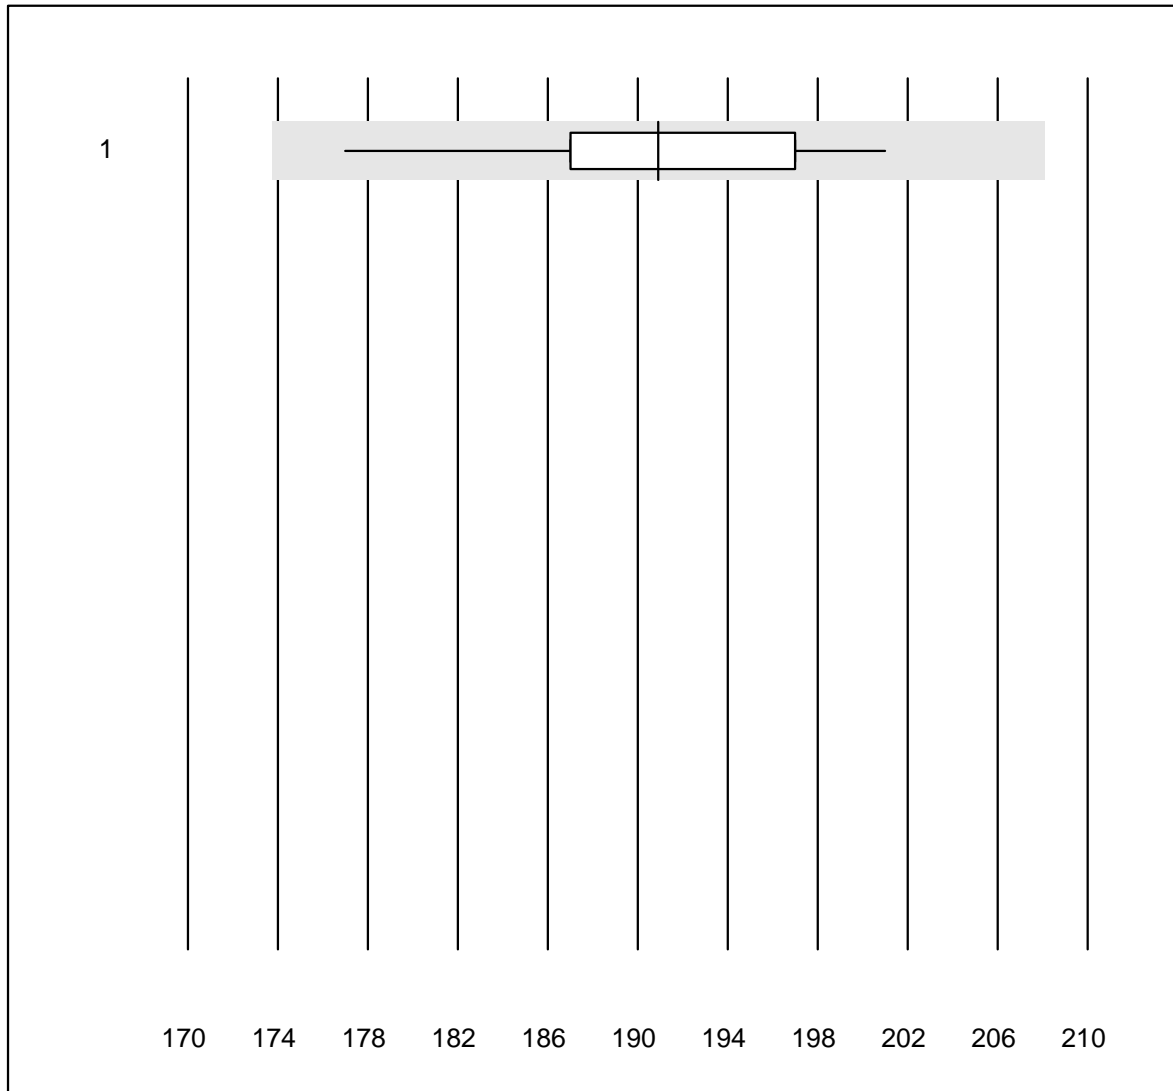


QUALAB Tolérance : 9 %

Hémoglobine BG (g/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 iStat	12	100.0	0.0	0.0	190.9	3.5	e

## Hématocrite

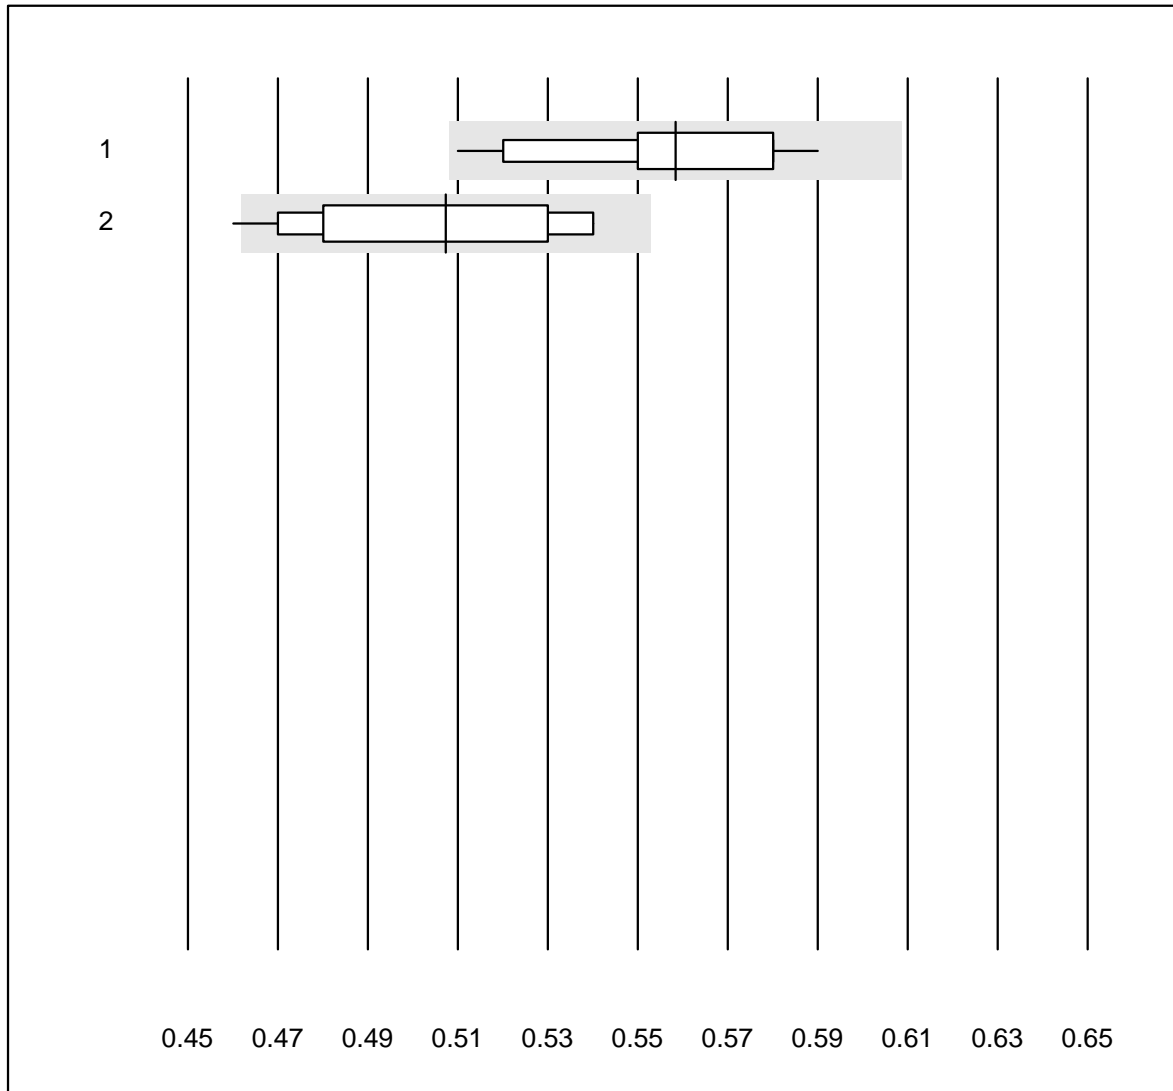


QUALAB Tolérance : 9 %

Hématocrite (l/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 iStat	19	100.0	0.0	0.0	0.56	3.6	e
2 EPOC	11	90.9	9.1	0.0	0.51	5.3	e*

## Hémoglobine

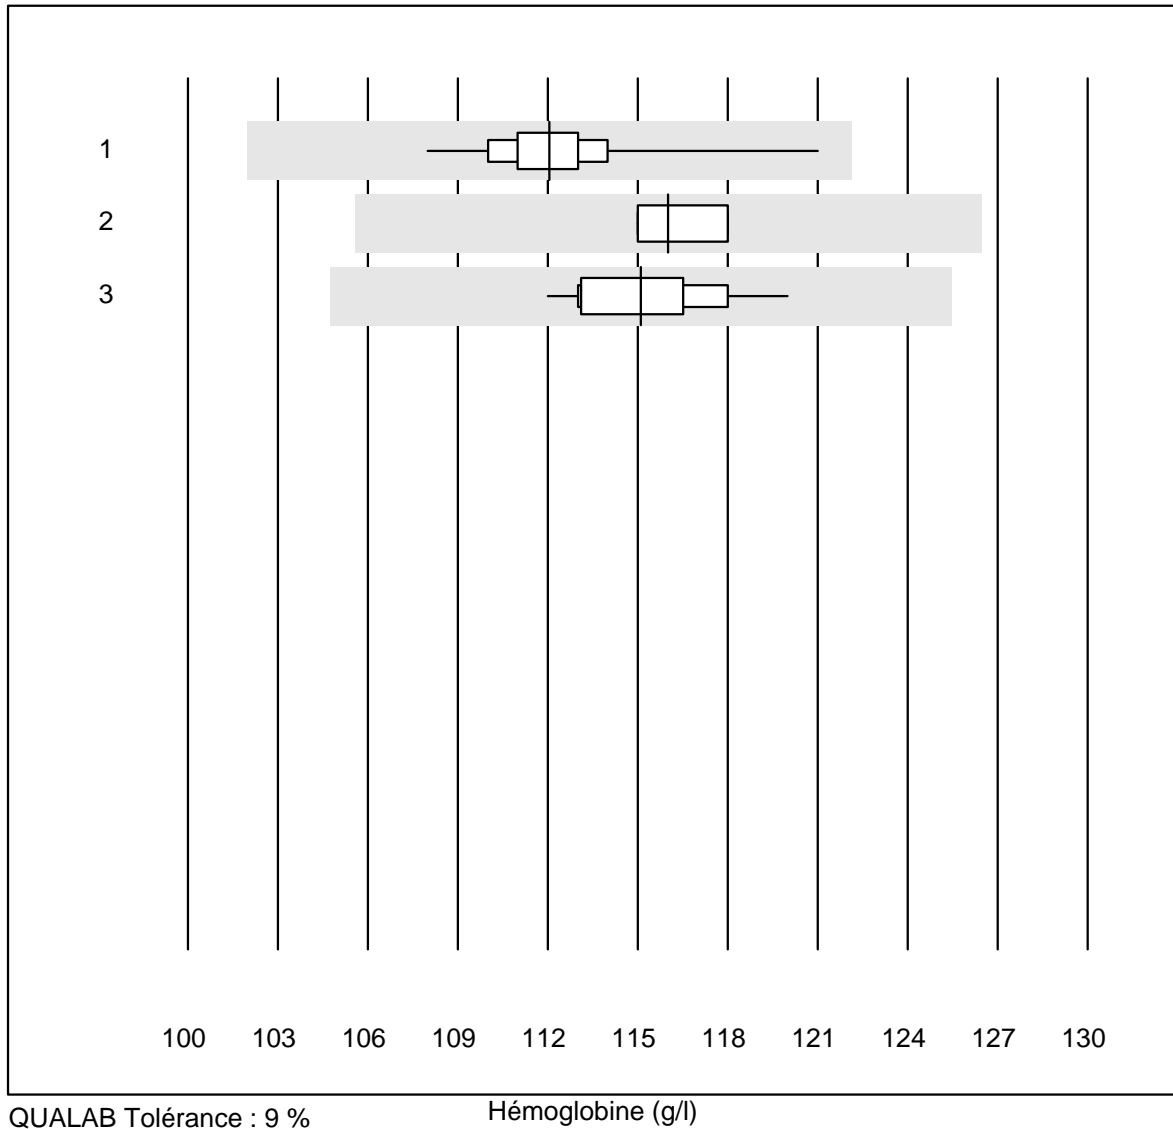

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	87	100.0	0.0	0.0	112.1	1.6	e
2 Advia	5	100.0	0.0	0.0	116.0	1.3	e
3 Yumizen/Pentra	15	100.0	0.0	0.0	115.1	1.9	e

## Hématocrite

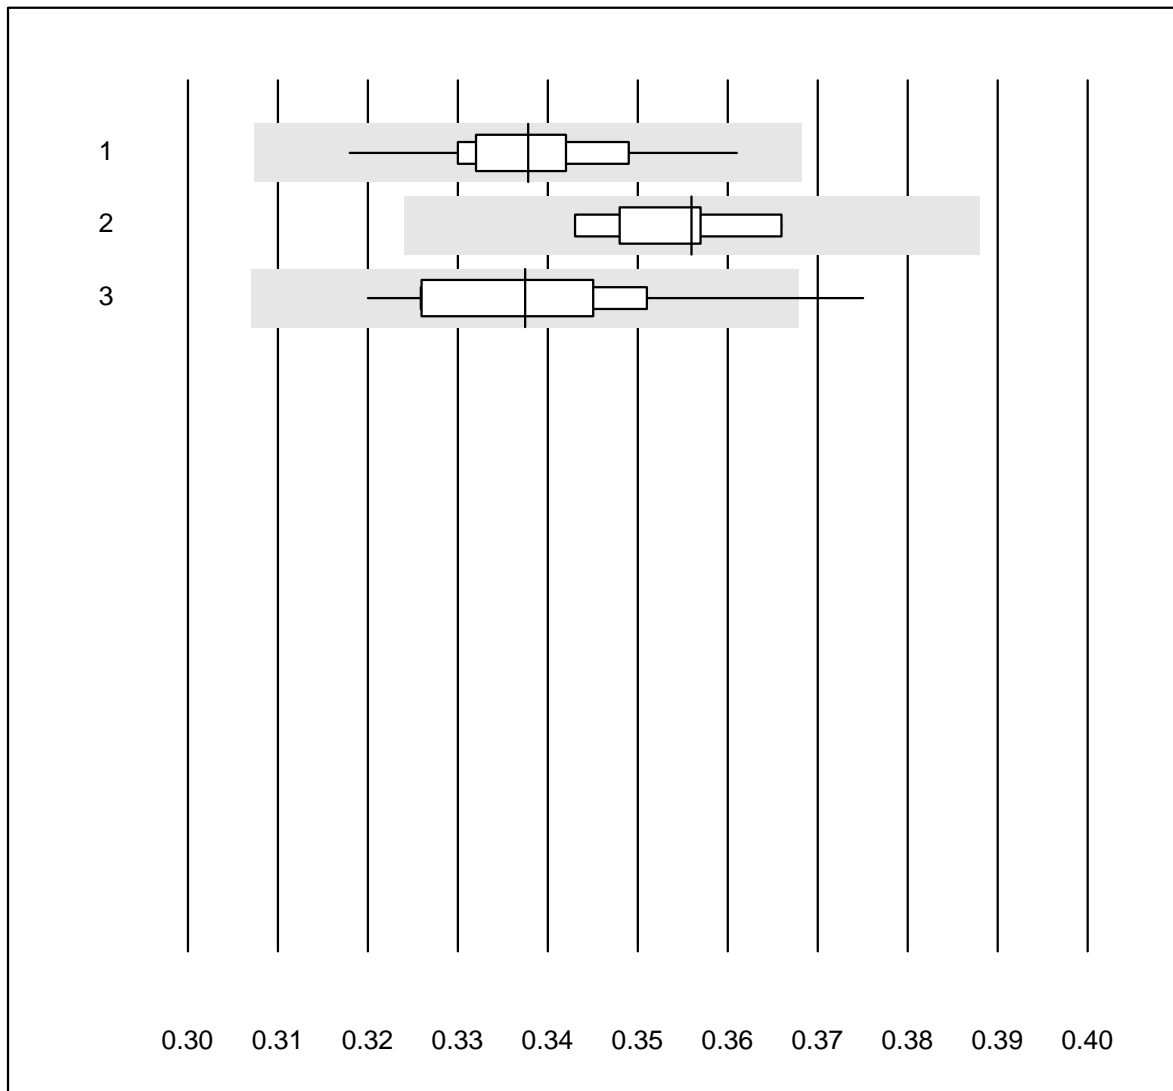


QUALAB Tolérance : 9 %

Hématocrite (l/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	89	100.0	0.0	0.0	0.34	2.5	e
2 Advia	5	100.0	0.0	0.0	0.36	2.5	e*
3 Yumizen/Pentra	15	93.3	6.7	0.0	0.34	4.1	e

## Erythrocytes

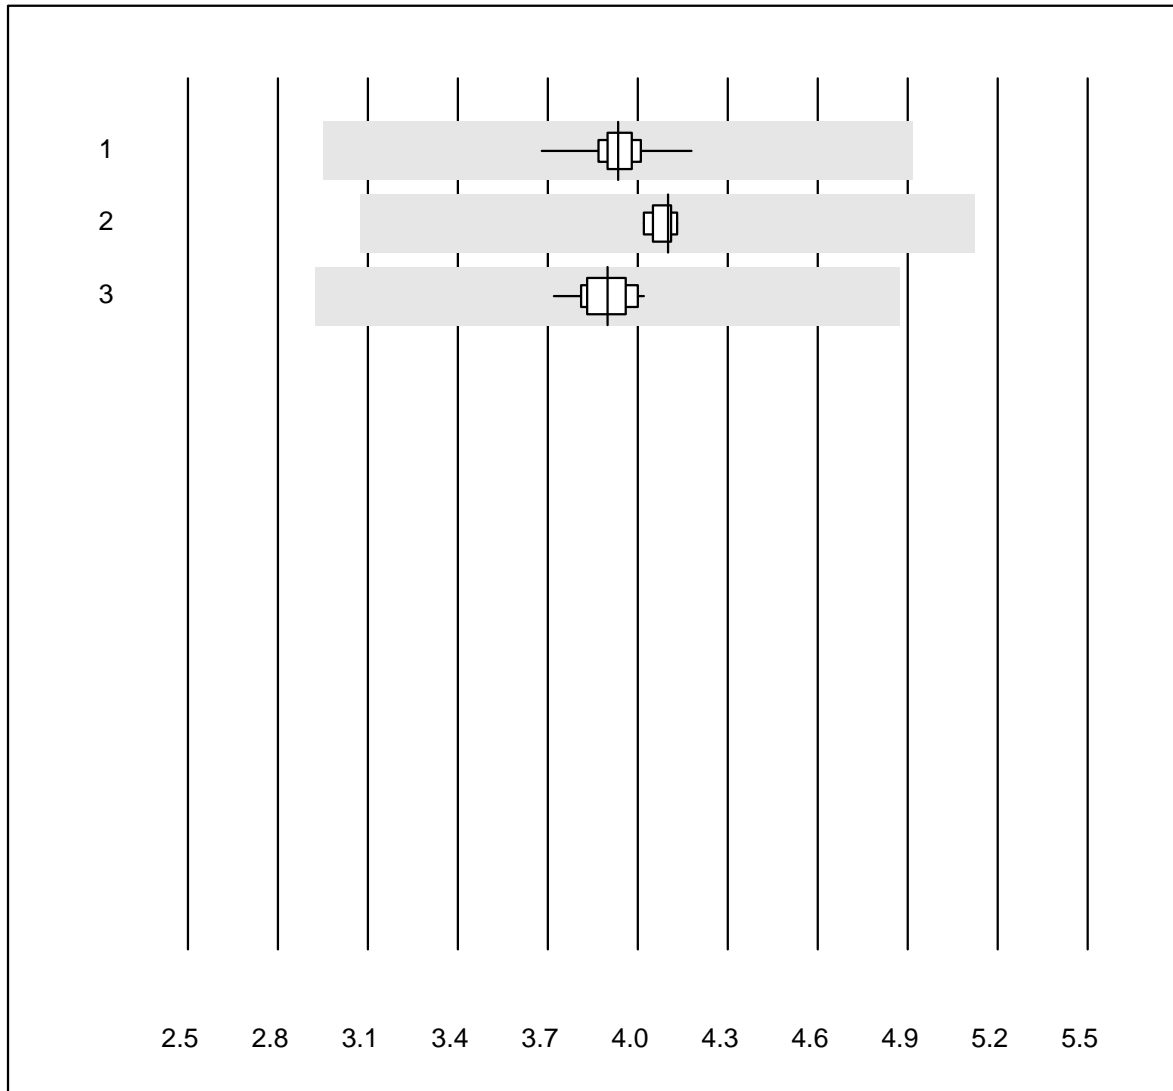


QUALAB Tolérance : 25 %

Erythrocytes (T/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	89	100.0	0.0	0.0	3.93	1.8	e
2 Advia	5	100.0	0.0	0.0	4.10	1.1	e
3 Yumizen/Pentra	15	93.3	0.0	6.7	3.90	2.2	e



## Leucocytes

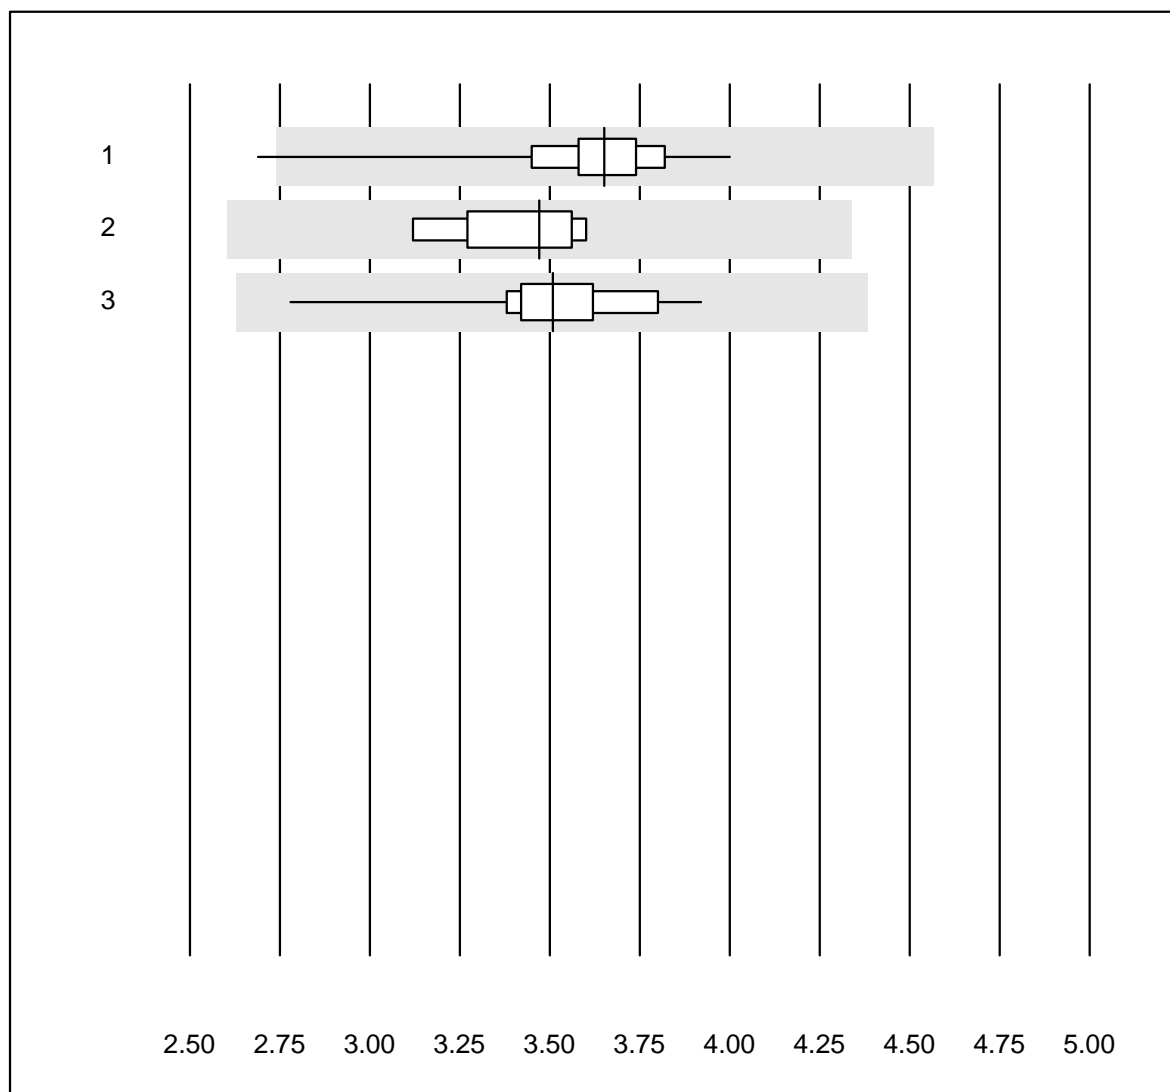


QUALAB Tolérance : 25 %

Leucocytes (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	88	98.9	1.1	0.0	3.65	4.8	e
2 Advia	5	100.0	0.0	0.0	3.47	6.0	e
3 Yumizen/Pentra	12	100.0	0.0	0.0	3.51	7.9	e

## Thrombocytes

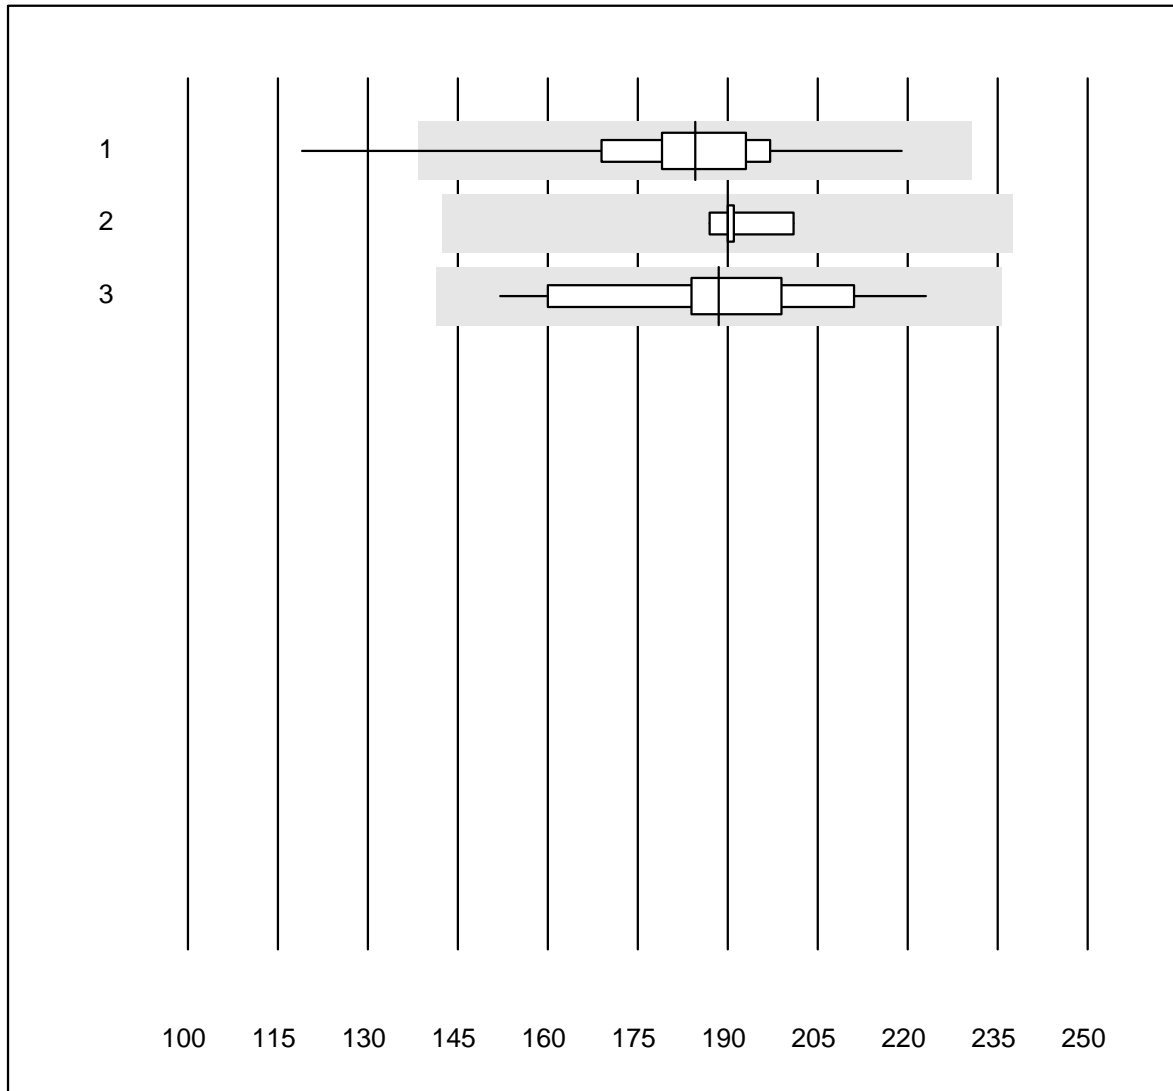


QUALAB Tolérance : 25 %

Thrombocytes (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	87	97.7	2.3	0.0	184.5	7.8	e
2 Advia	5	100.0	0.0	0.0	190.0	2.8	e
3 Yumizen/Pentra	15	100.0	0.0	0.0	188.5	9.6	e

## Neutrophiles

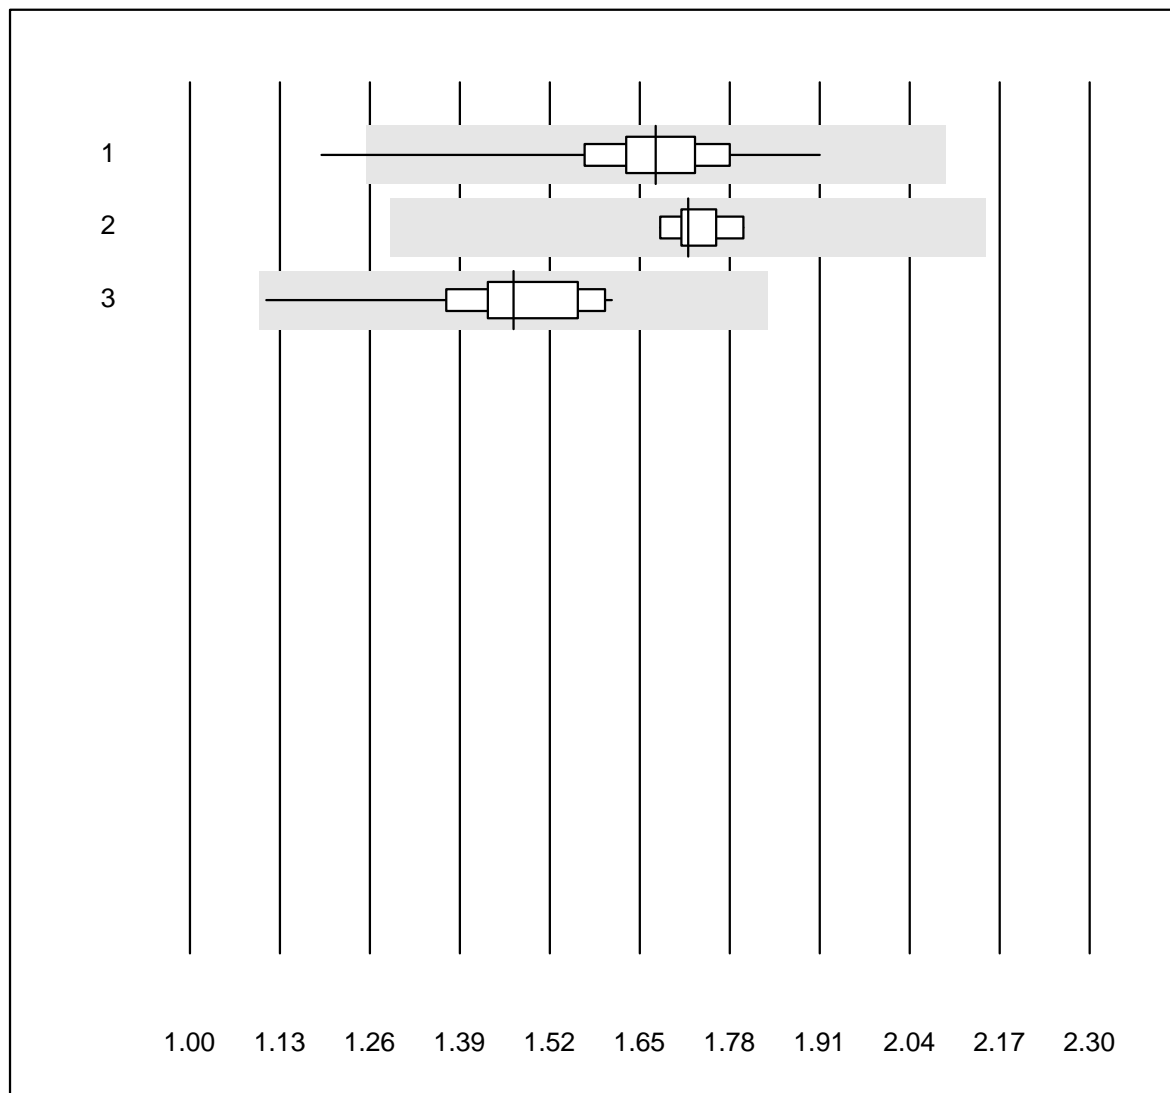


Tolérance MQ : 25 %

Neutrophiles (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	89	97.8	1.1	1.1	1.67	5.7	e
2 Advia	5	100.0	0.0	0.0	1.72	2.7	e
3 Yumizen/Pentra	11	100.0	0.0	0.0	1.47	9.5	e

## Lymphocytes

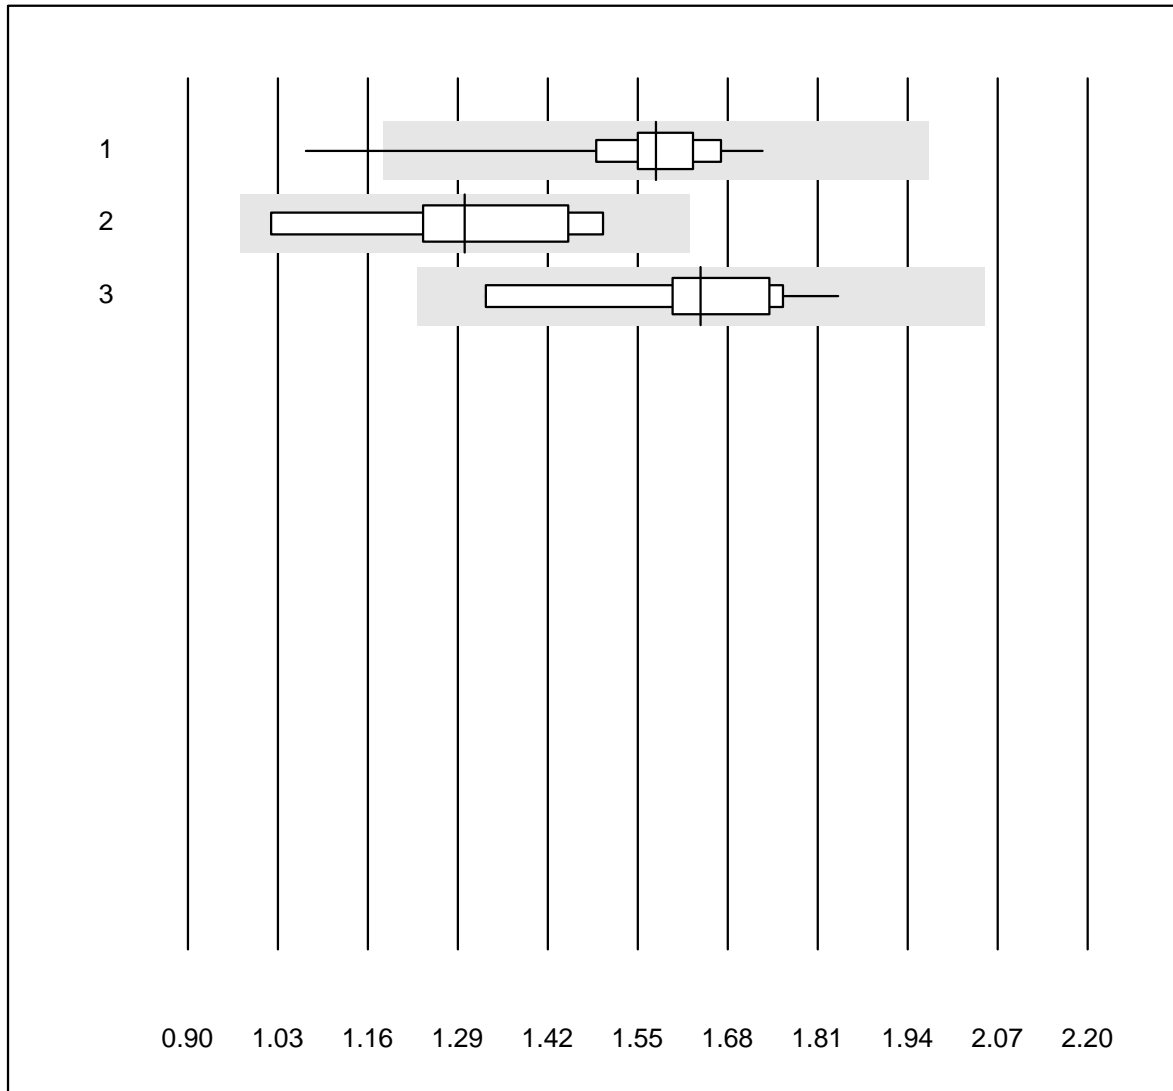


Tolérance MQ : 25 %

Lymphocytes (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	89	98.9	1.1	0.0	1.58	6.1	e
2 Advia	5	100.0	0.0	0.0	1.30	14.6	a
3 Yumizen/Pentra	11	90.9	0.0	9.1	1.64	8.5	e

## Monocytes

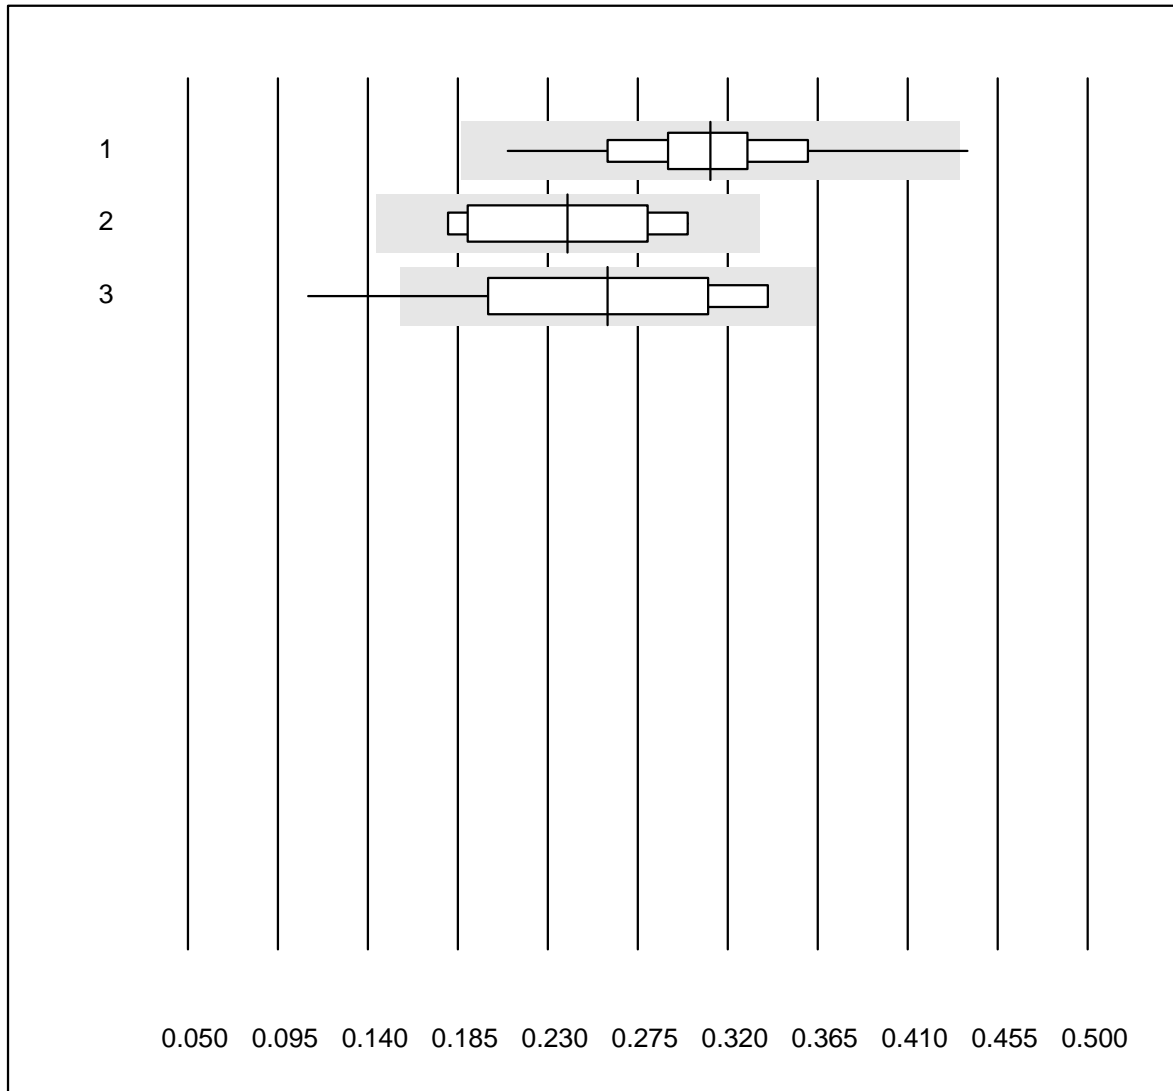


Tolérance MQ : 40 %

Monocytes (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	89	98.9	1.1	0.0	0.31	12.9	e
2 Advia	5	100.0	0.0	0.0	0.24	22.3	e*
3 Yumizen/Pentra	12	91.7	8.3	0.0	0.26	26.8	e*

## Eosinophiles

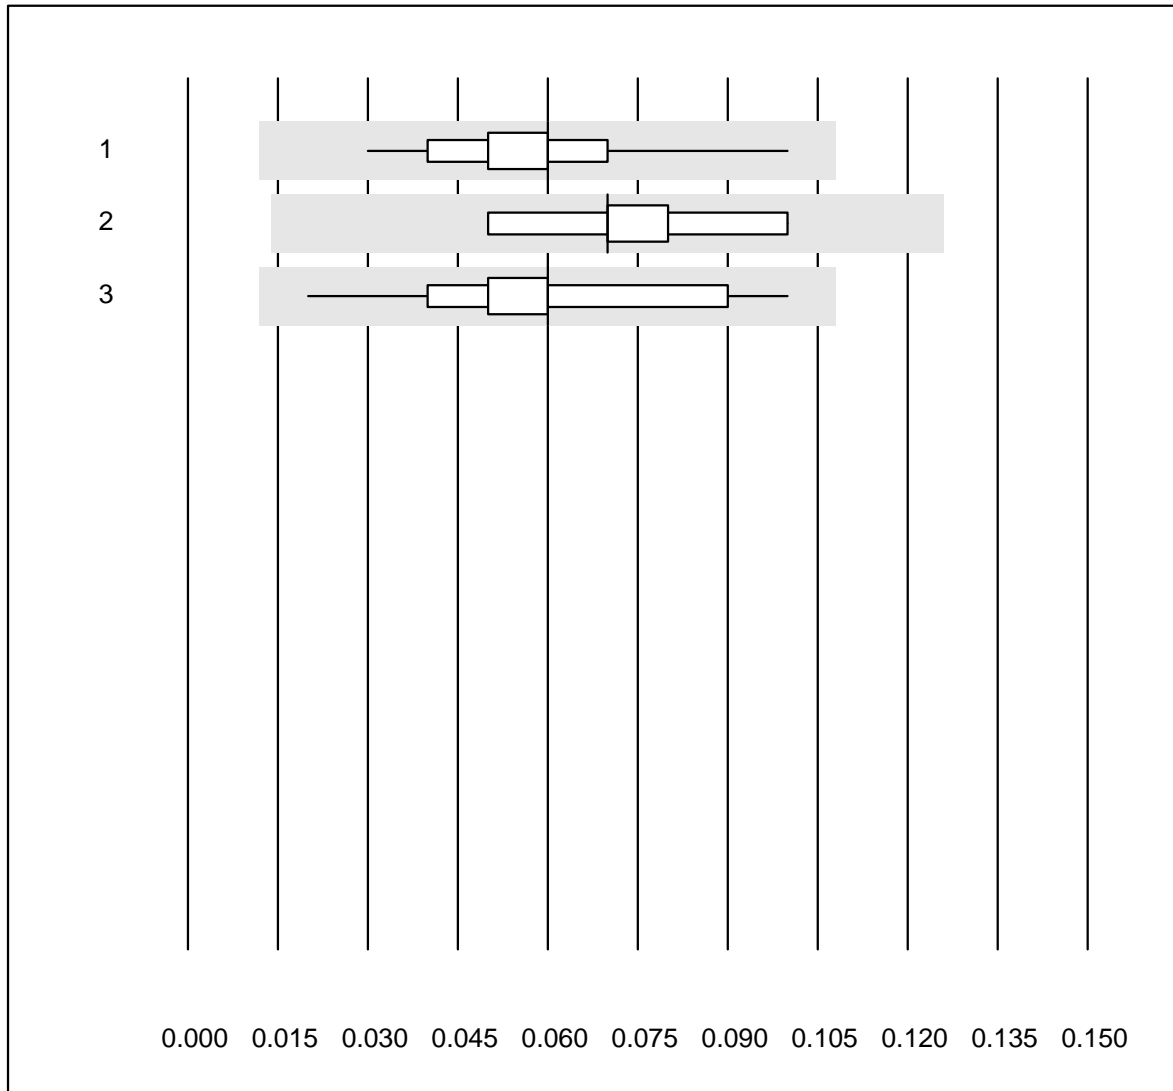


Tolérance MQ : 80 %

Eosinophiles (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	88	98.9	0.0	1.1	0.06	27.9	a
2 Advia	5	100.0	0.0	0.0	0.07	24.5	e*
3 Yumizen/Pentra	12	100.0	0.0	0.0	0.06	37.8	a

## Basophiles

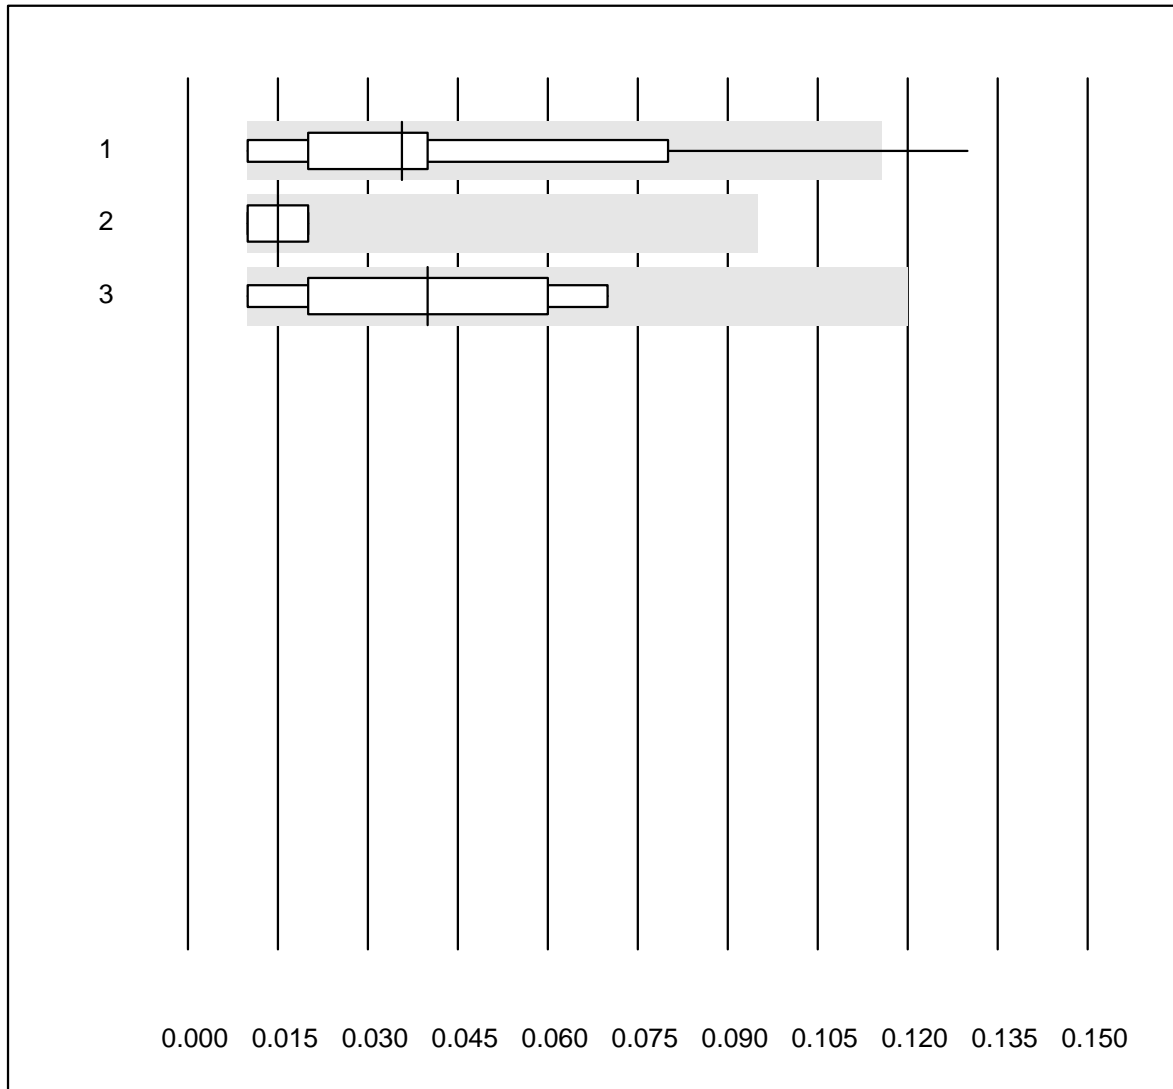


Tolérance MQ : 80 %  
( < 0.10: +/- 0.08 G/l)

Basophiles (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	90	95.6	2.2	2.2	0.04	77.4	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	0.02	38.5	e*
3 Yumizen/Pentra	12	100.0	0.0	0.0	0.04	56.4	e*

## MCV

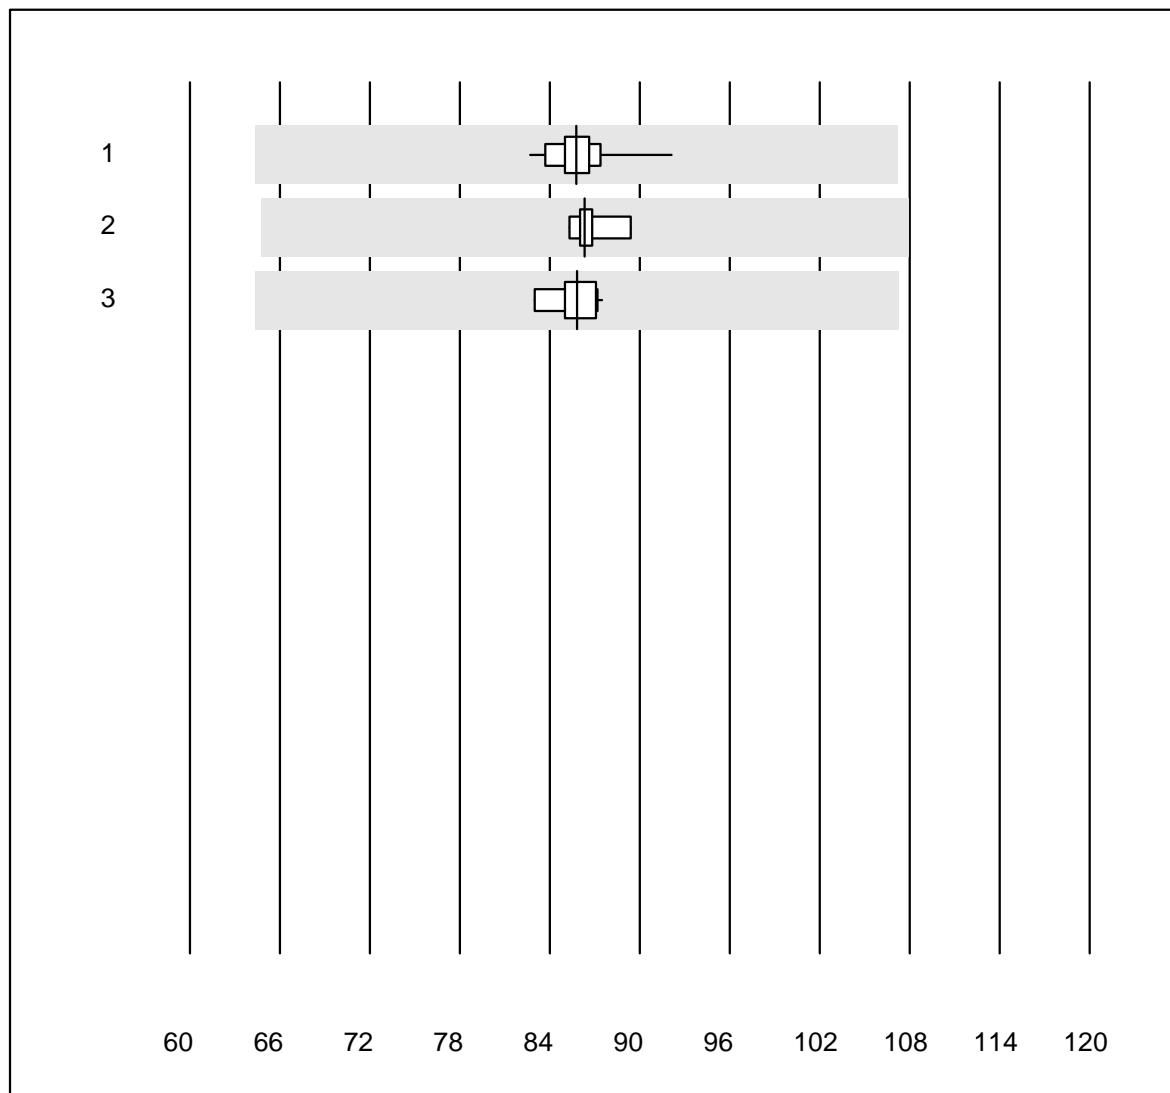


Tolérance MQ : 25 %

MCV (fl)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	80	100.0	0.0	0.0	85.8	1.9	e
2 Advia	5	100.0	0.0	0.0	86.3	1.8	e
3 Yumizen/Pentra	10	100.0	0.0	0.0	85.8	1.7	e



# MCH

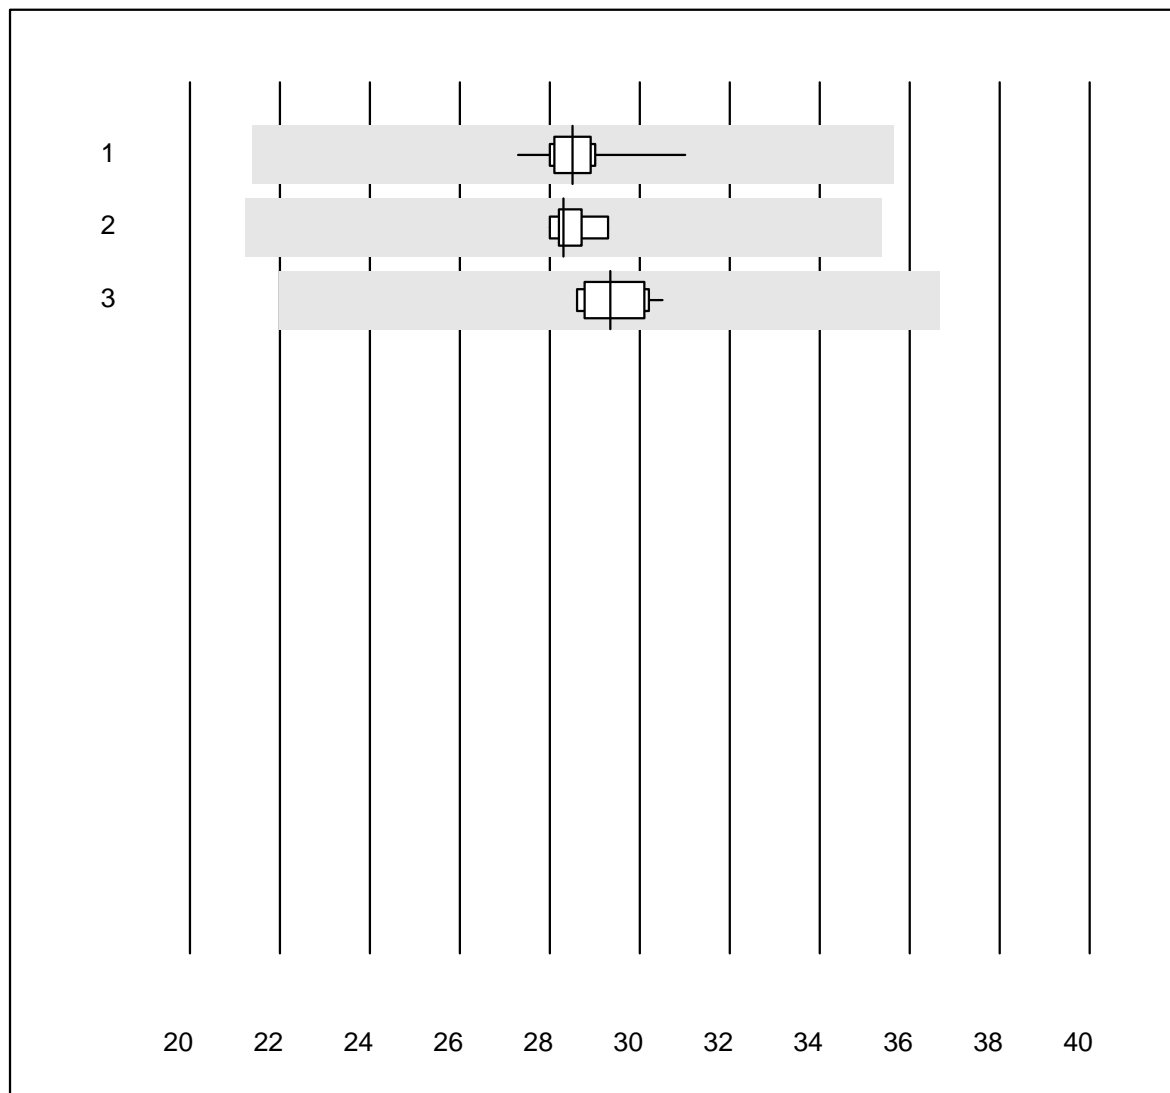


Tolérance MQ : 25 %

MCH (pg)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	80	100.0	0.0	0.0	28.5	1.7	e
2 Advia	5	100.0	0.0	0.0	28.3	1.8	e
3 Yumizen/Pentra	10	100.0	0.0	0.0	29.3	2.3	e

# MCHC

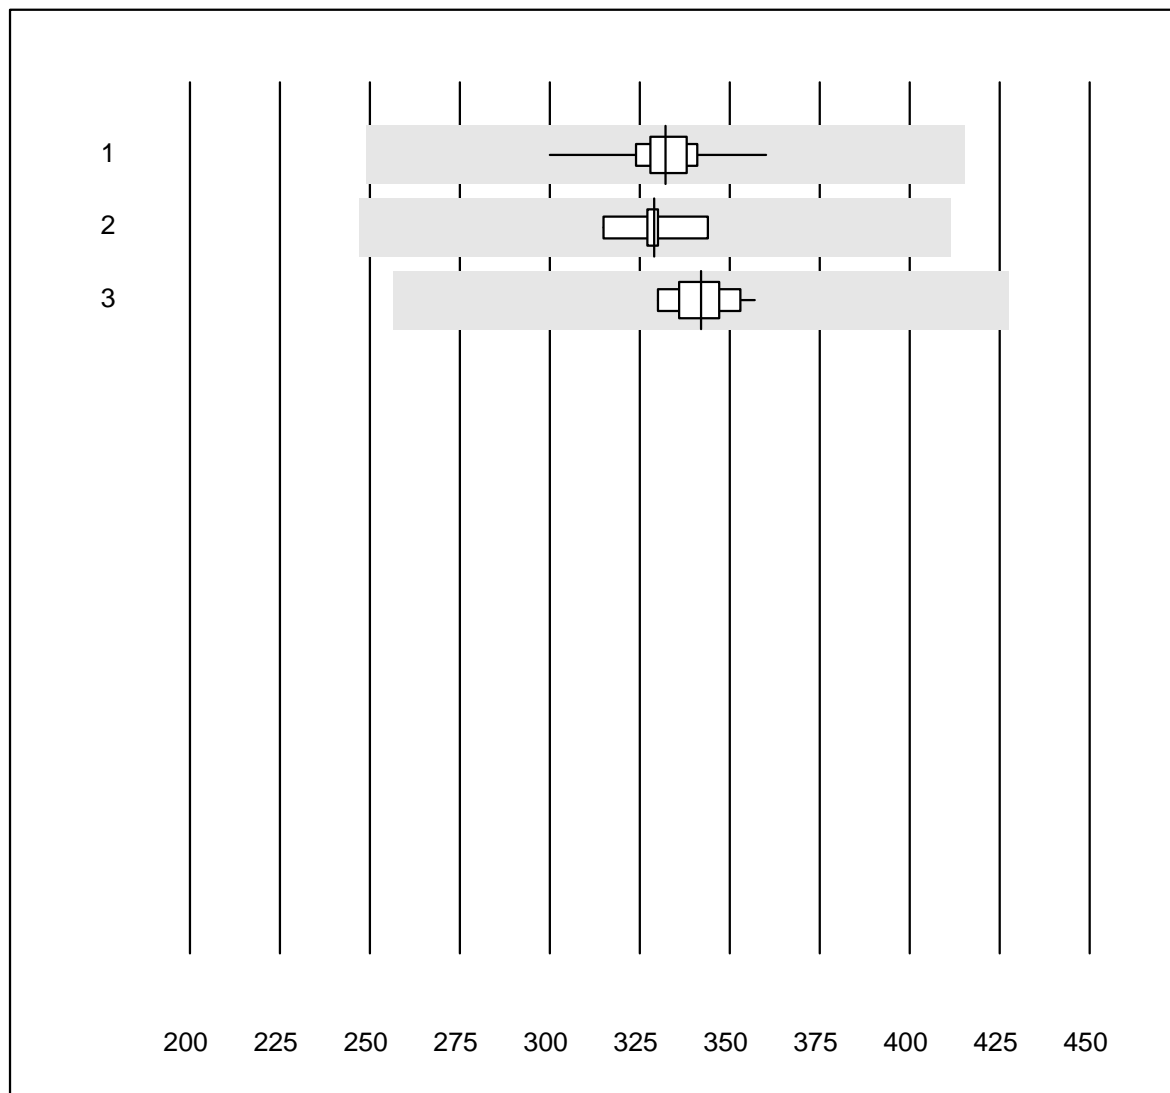


Tolérance MQ : 25 %

MCHC (g/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	81	100.0	0.0	0.0	332	2.6	e
2 Advia	5	100.0	0.0	0.0	329	3.1	e
3 Yumizen/Pentra	10	100.0	0.0	0.0	342	2.5	e

## RDW

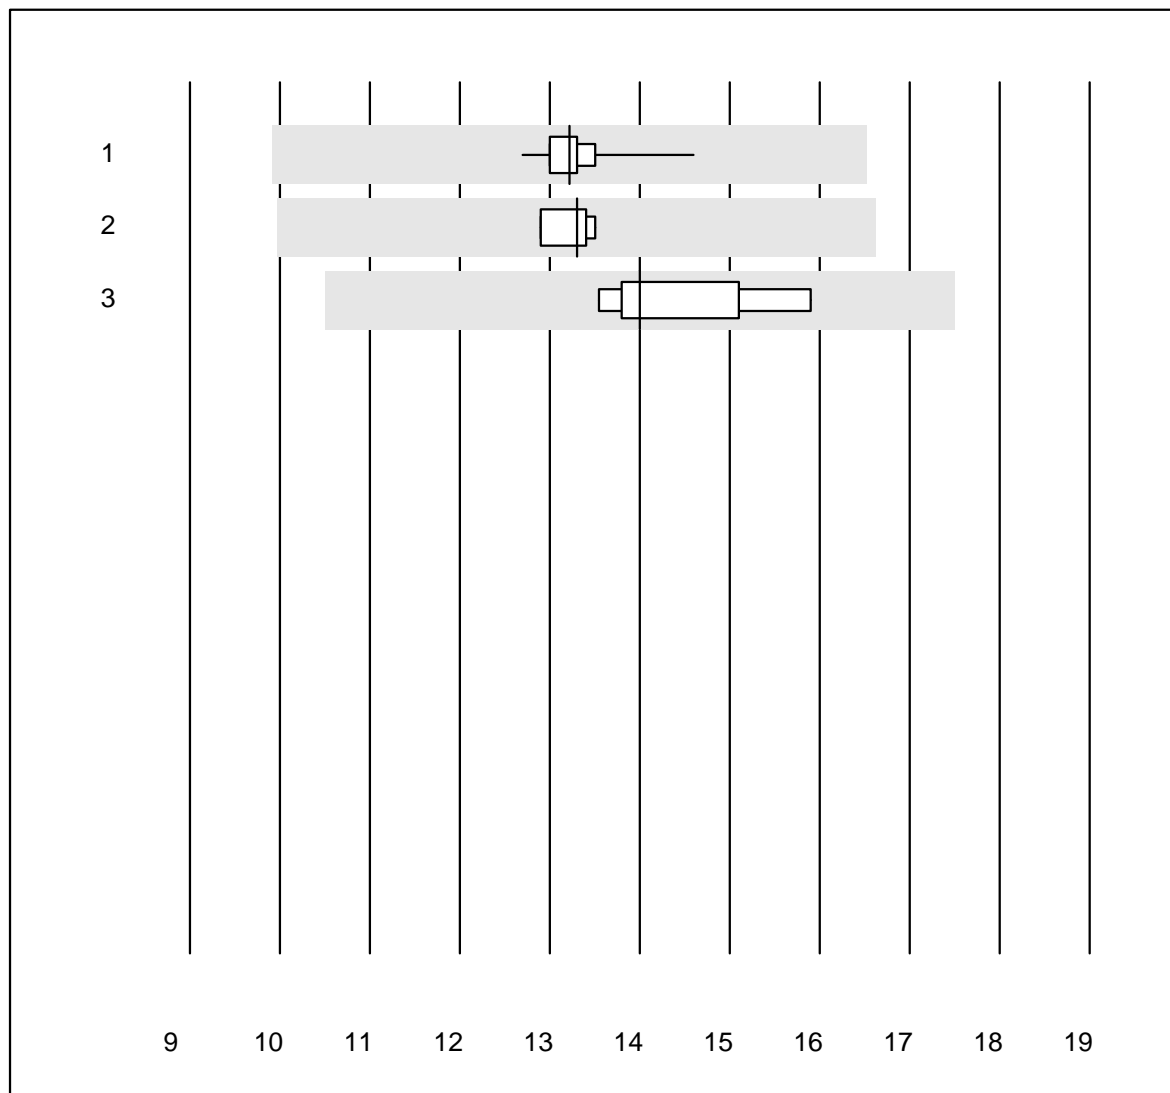


Tolérance MQ : 25 %

RDW (%)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	78	100.0	0.0	0.0	13.2	2.3	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	13.3	2.0	e
3 Yumizen/Pentra	9	100.0	0.0	0.0	14.0	5.9	e

## Immature Granulocytes

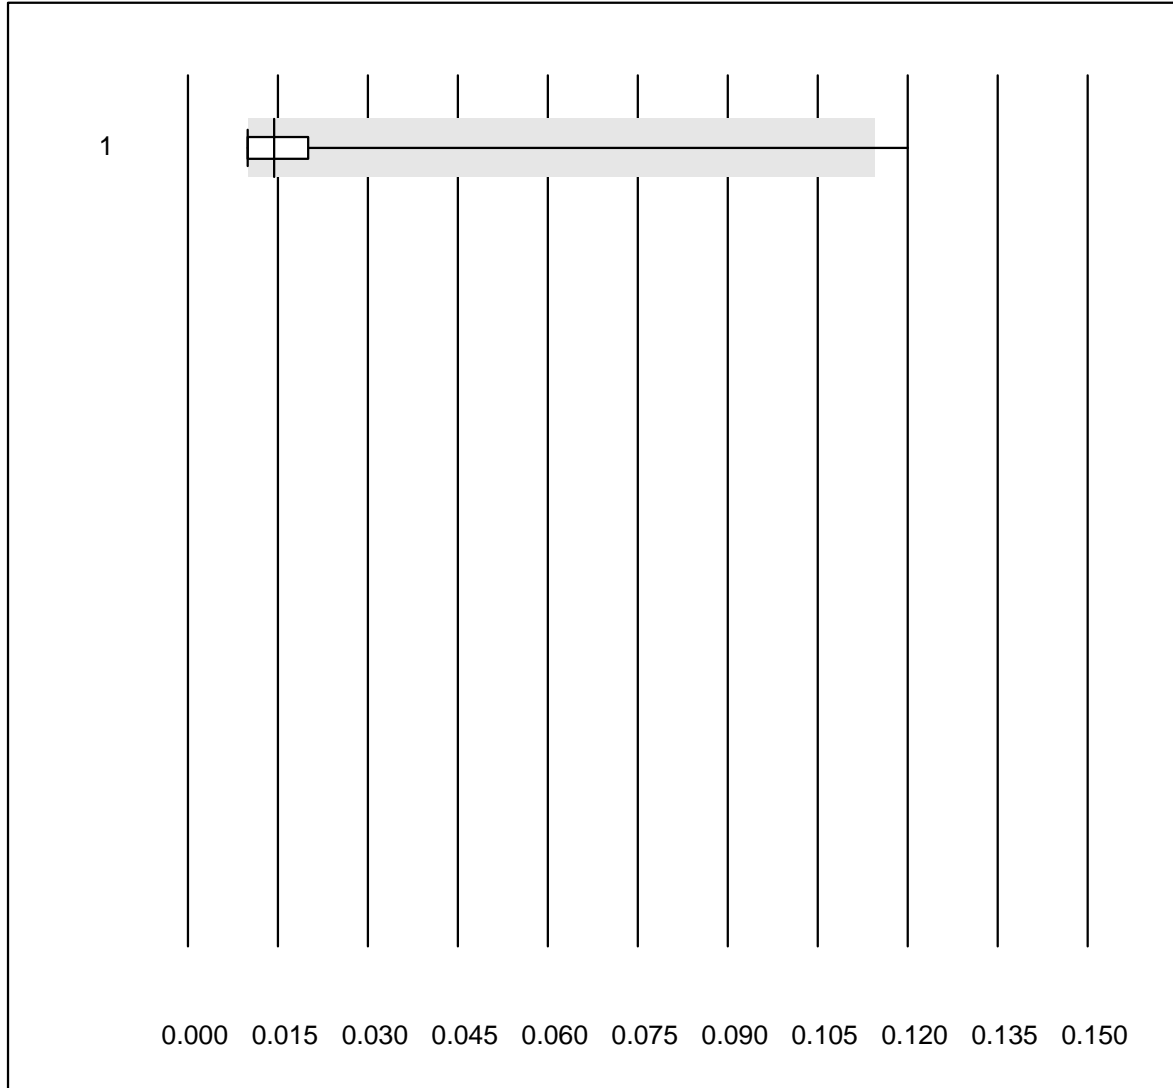


Tolérance MQ : 25 %  
 (< 0.10: +/- 0.10 G/l)

Immature Granulocytes (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	64	98.4	1.6	0.0	0.01	100.6	e*

## Réticulocytes

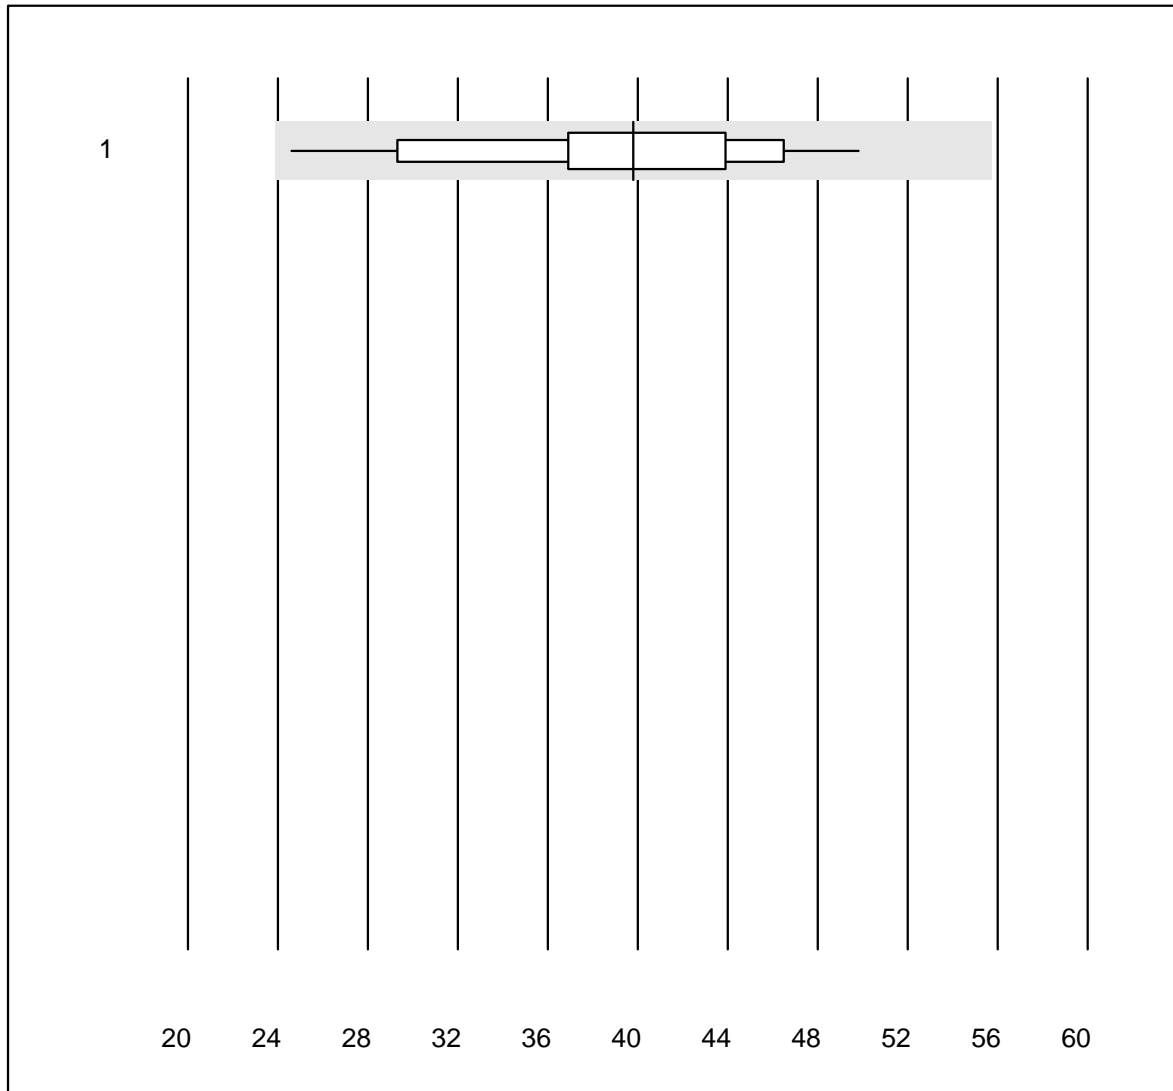


Tolérance MQ : 30 %

Réticulocytes (G/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	43	100.0	0.0	0.0	39.8	15.0	a

## Index hémolytique échantillon A

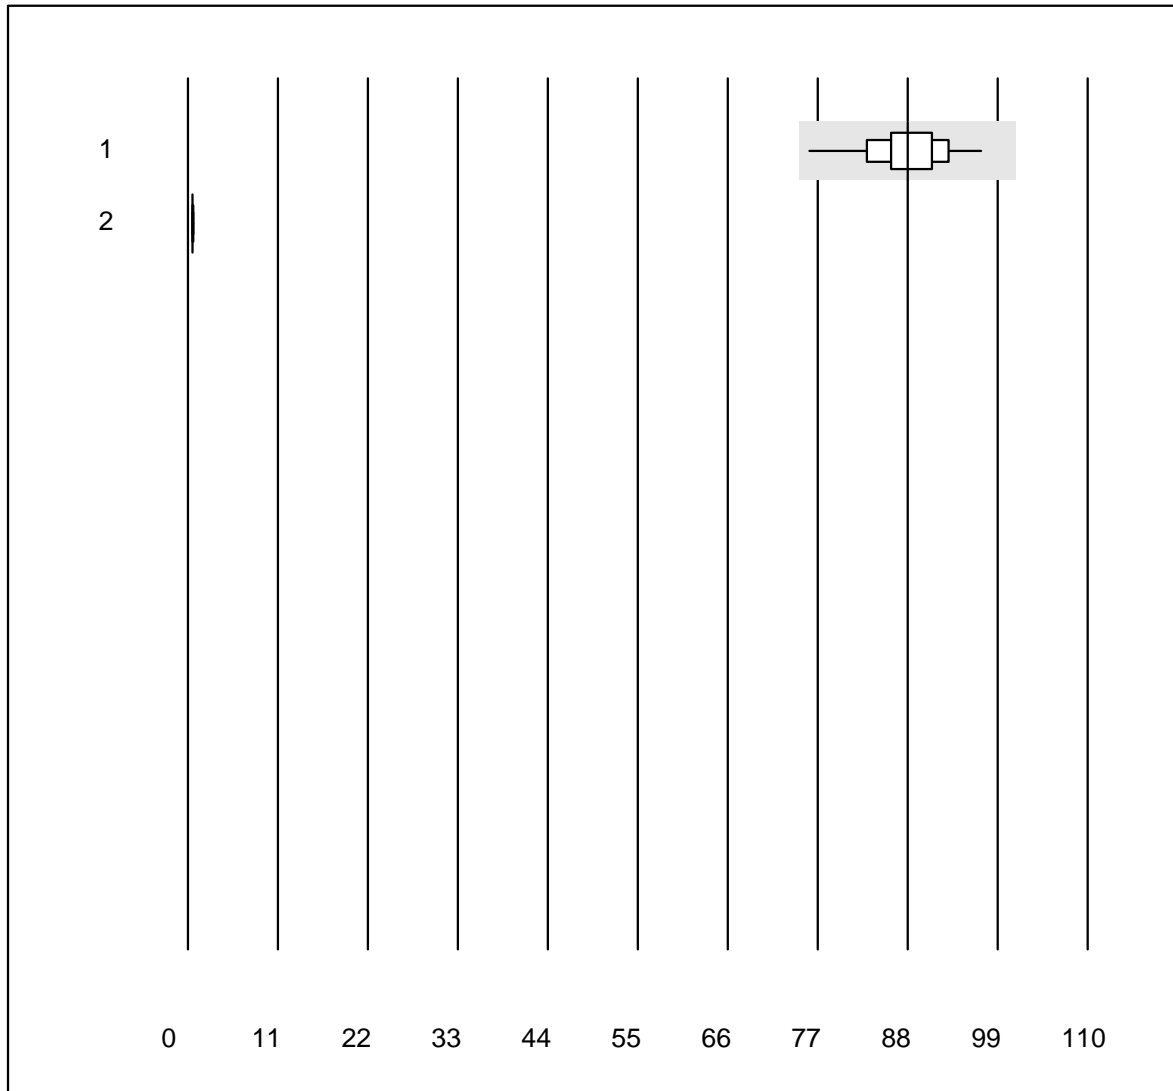


Tolérance MQ : 15 %

Index hémolytique échantillon A ( )

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	88.00	5.3	e
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	0.60	4.8	e*

## Index hémolytique échantillon B

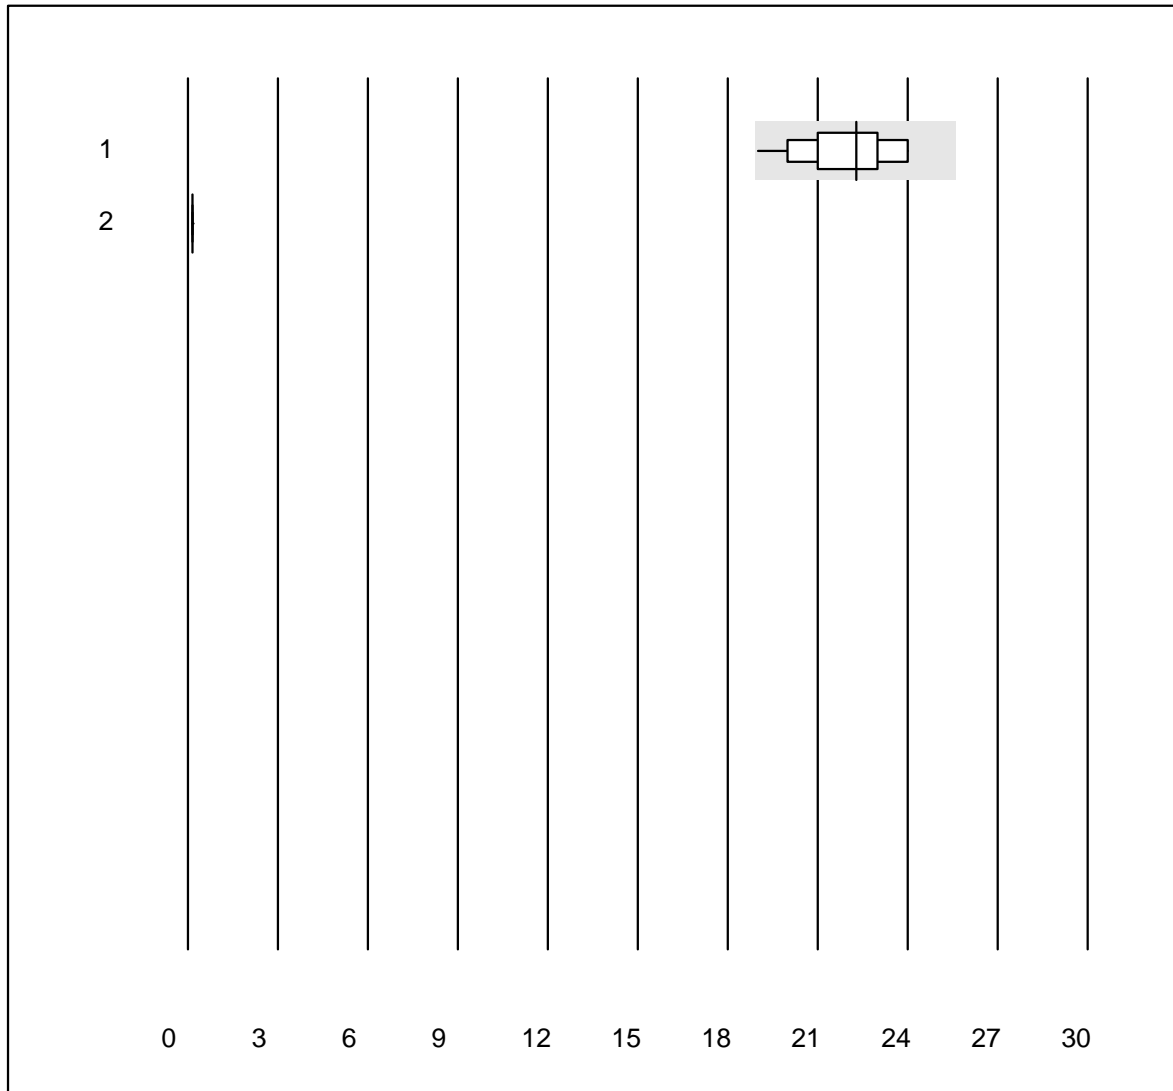


Tolérance MQ : 15 %

Index hémolytique échantillon B ( )

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	18	100.0	0.0	0.0	22.28	6.3	e
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	0.15	6.7	e*

## Vitesse de sédimentation 1h

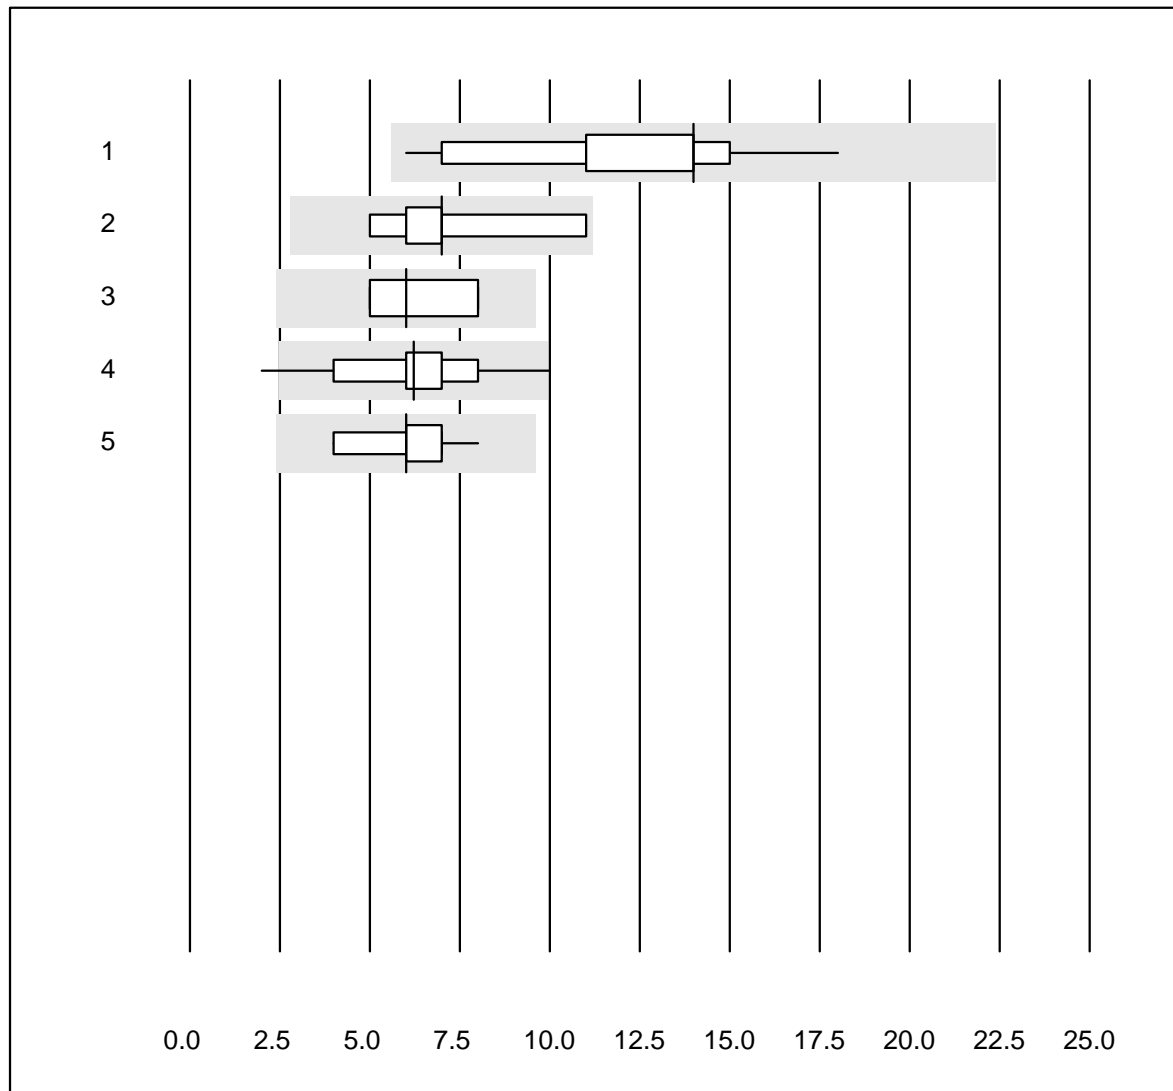


Tolérance MQ : 30 %

Vitesse de sédimentation 1h (mm/h)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 MINI-CUBE	11	100.0	0.0	0.0	14	27.5	a
2 Sarstedt Sedivette	12	100.0	0.0	0.0	7	28.5	a
3 Sarstedt Microvette	4	75.0	0.0	25.0	6	24.1	a
4 BD Seditainer	43	93.0	7.0	0.0	6	23.4	a
5 Autres méthodes	11	90.9	0.0	9.1	6	17.8	a



## Vitesse de sédimentation 2h

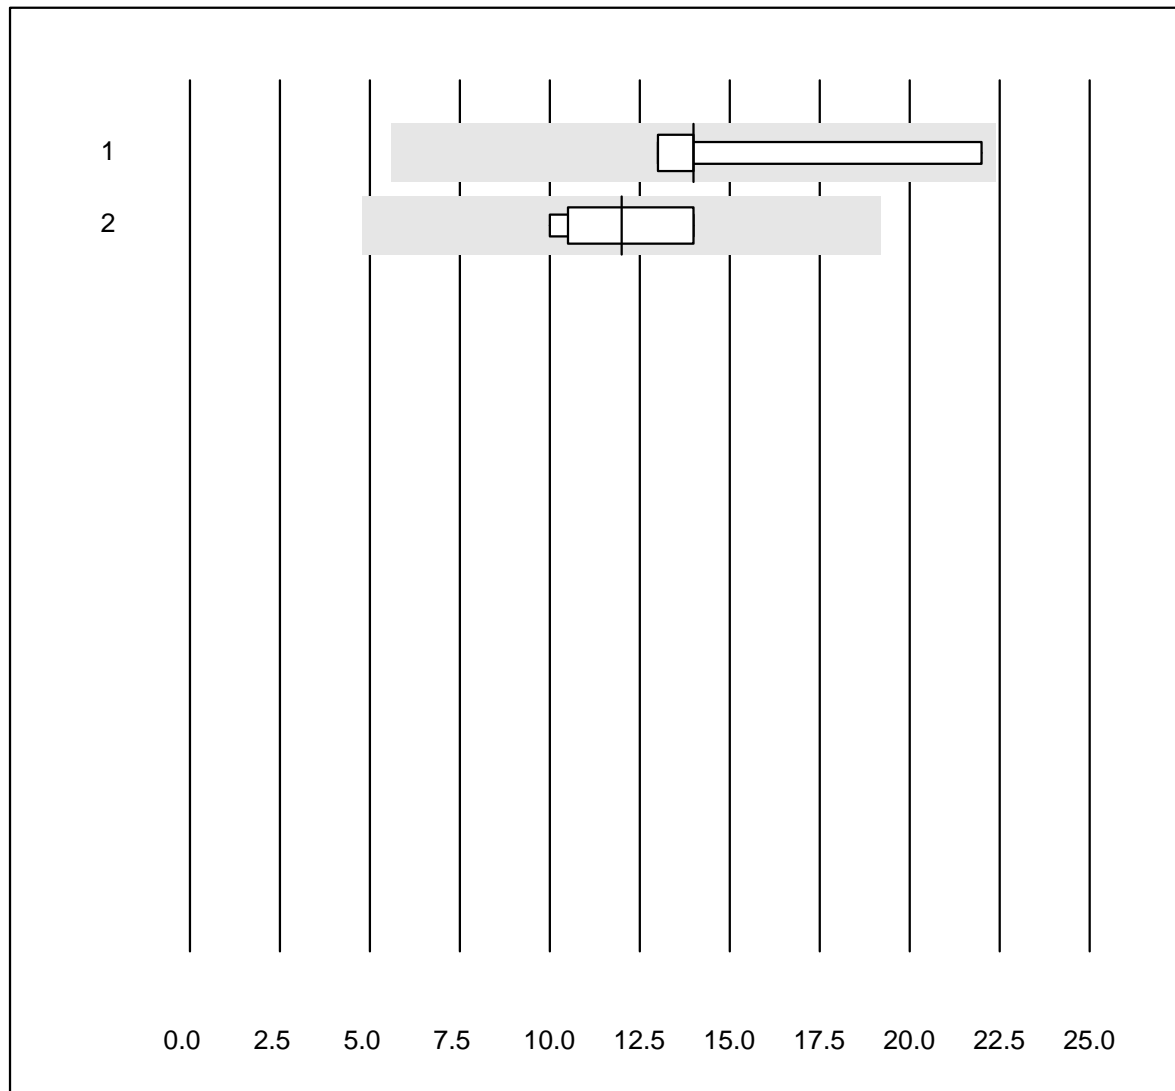


Tolérance MQ : 30 %

Vitesse de sédimentation 2h (mm/2h)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 BD Seditainer	6	100.0	0.0	0.0	14	23.1	a
2 Autres méthodes	5	100.0	0.0	0.0	12	15.6	a

## Hémoglobine HS

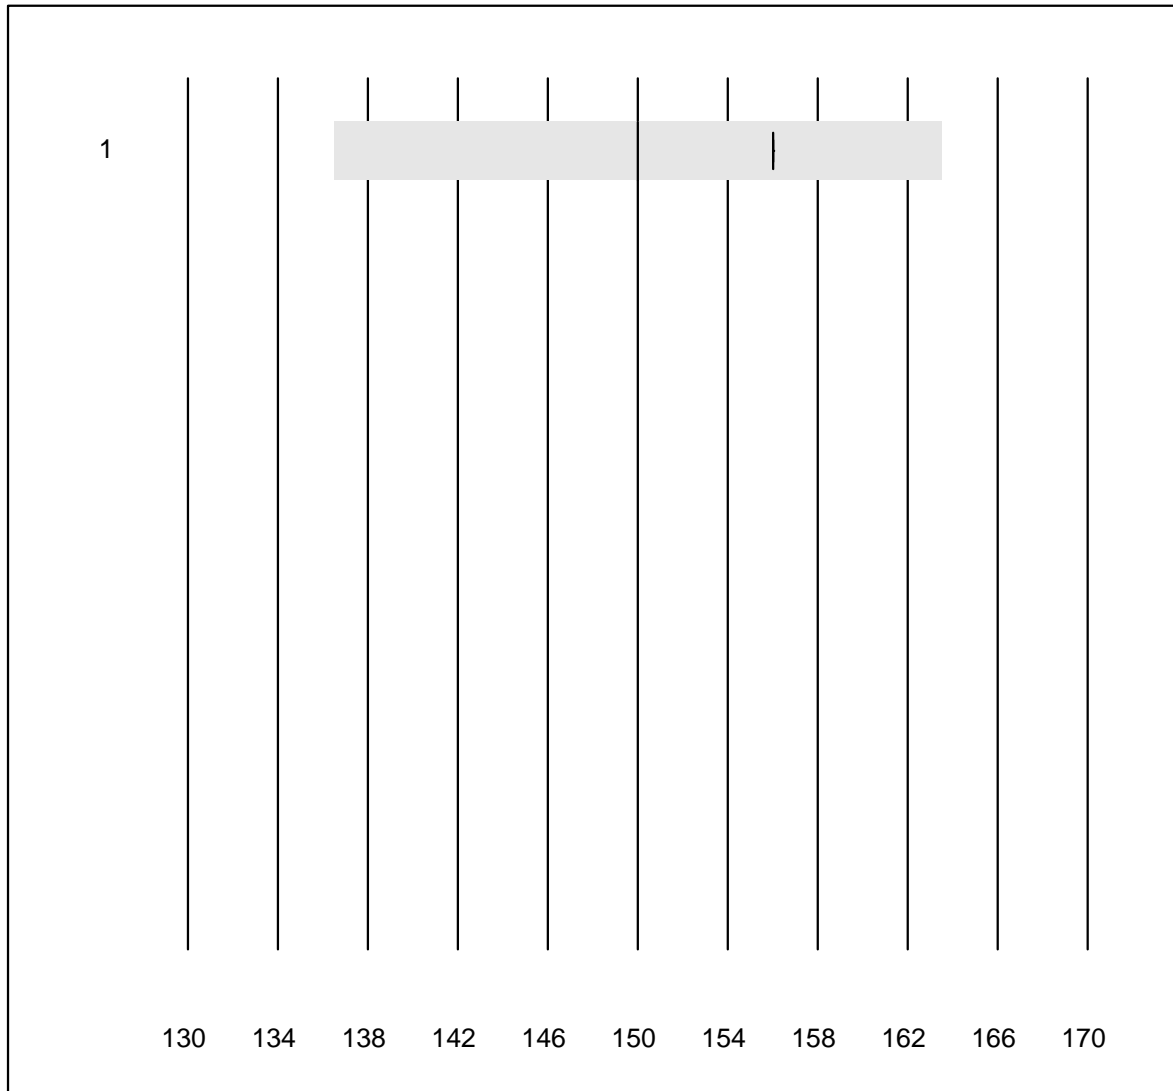


Tolérance MQ : 9 %

Hémoglobine HS (g/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 PixCell HemoScreen	4	50.0	0.0	50.0	150.0	0.0	a

## Hématocrit HS

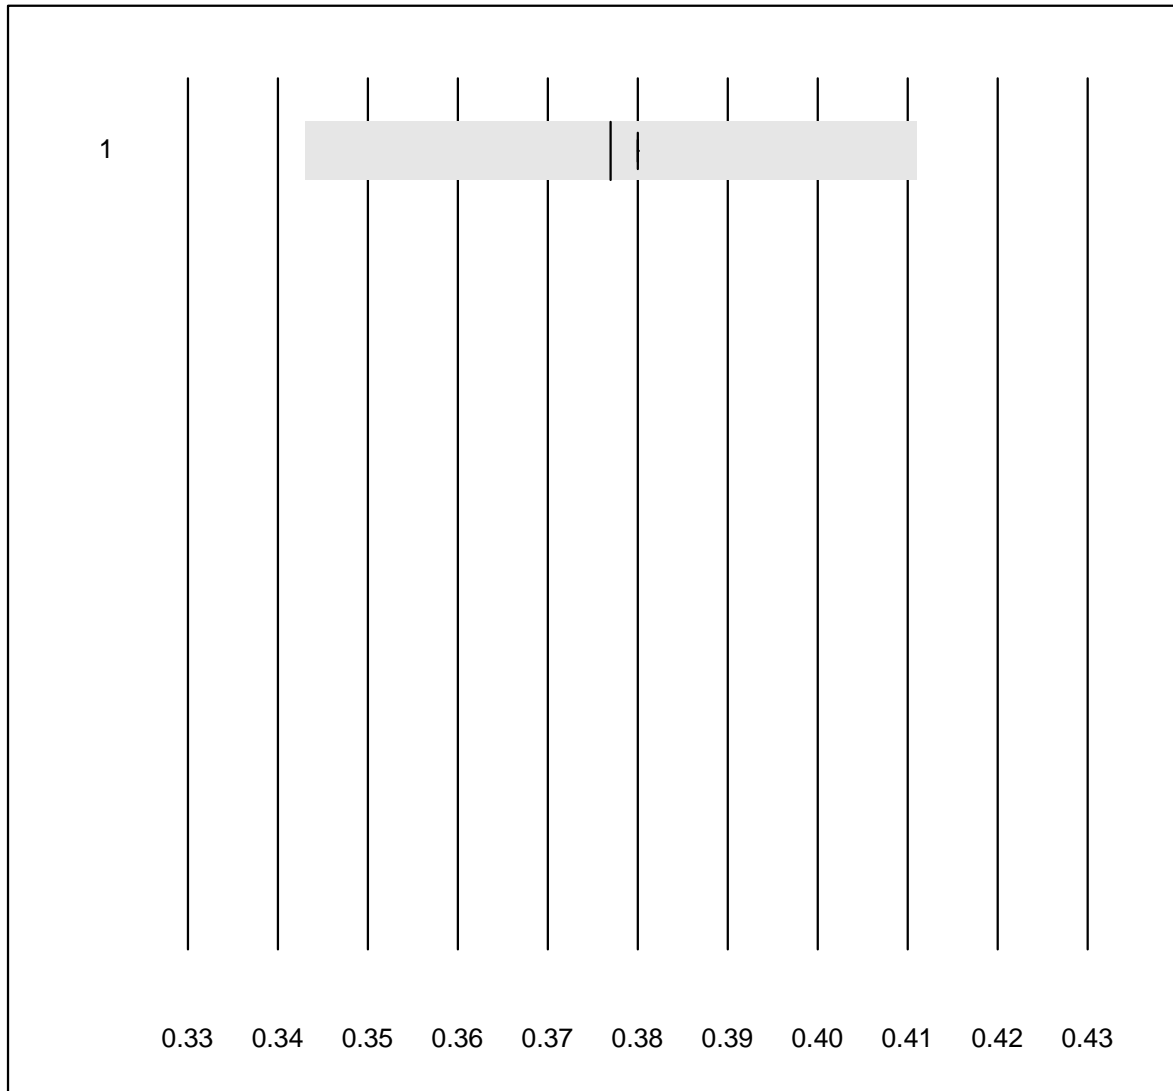


Tolérance MQ : 9 %

Hématocrit HS (l/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 PixCell HemoScreen	4	50.0	0.0	50.0	0.4	0.0	a

## Erythrocytes HS

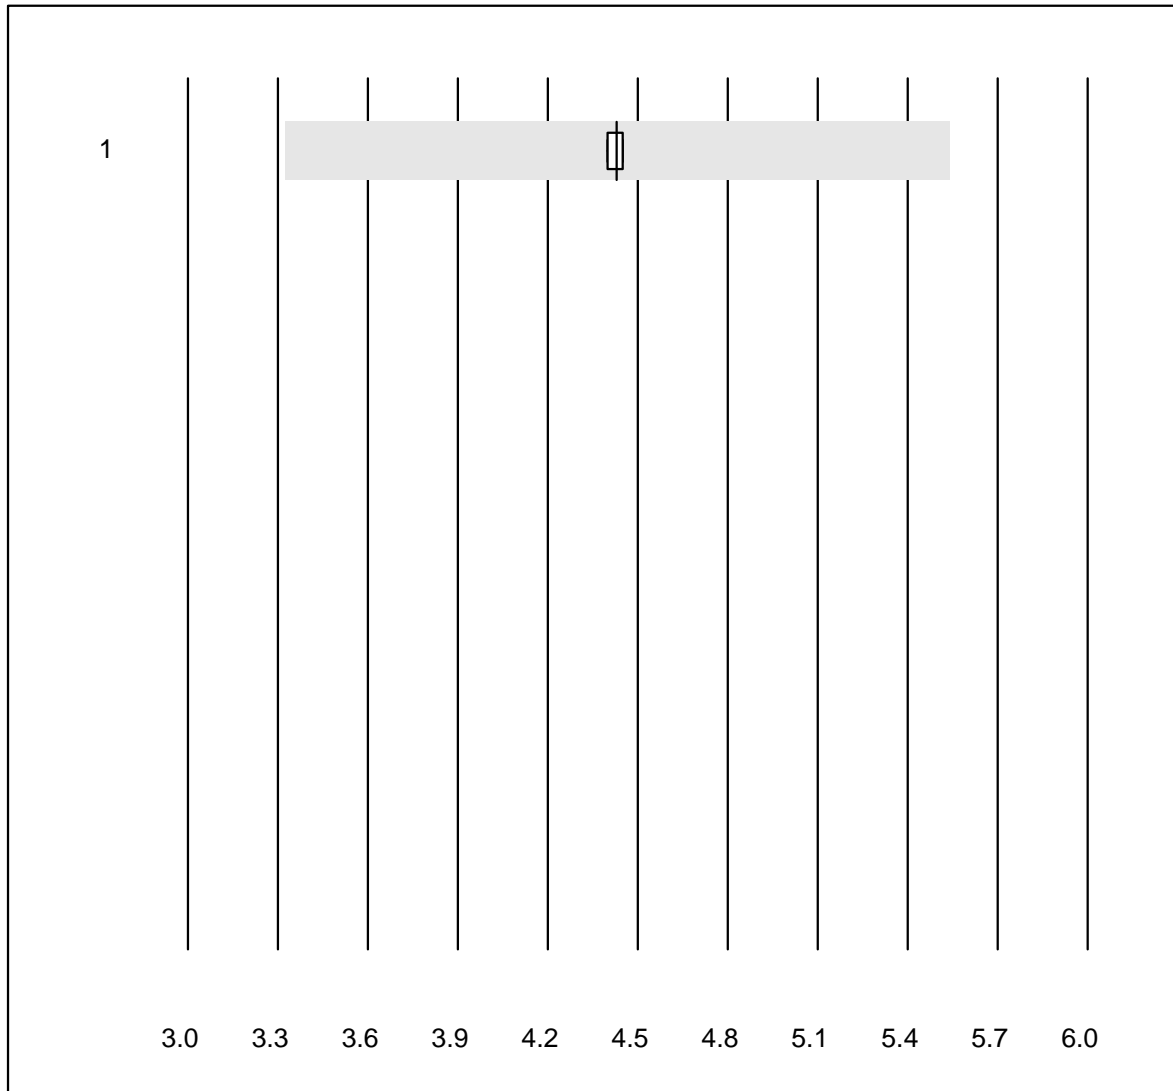


Tolérance MQ : 25 %

Erythrocytes HS (T/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 PixCell HemoScreen	4	50.0	0.0	50.0	4.43	0.8	a

# Leucocytes HS

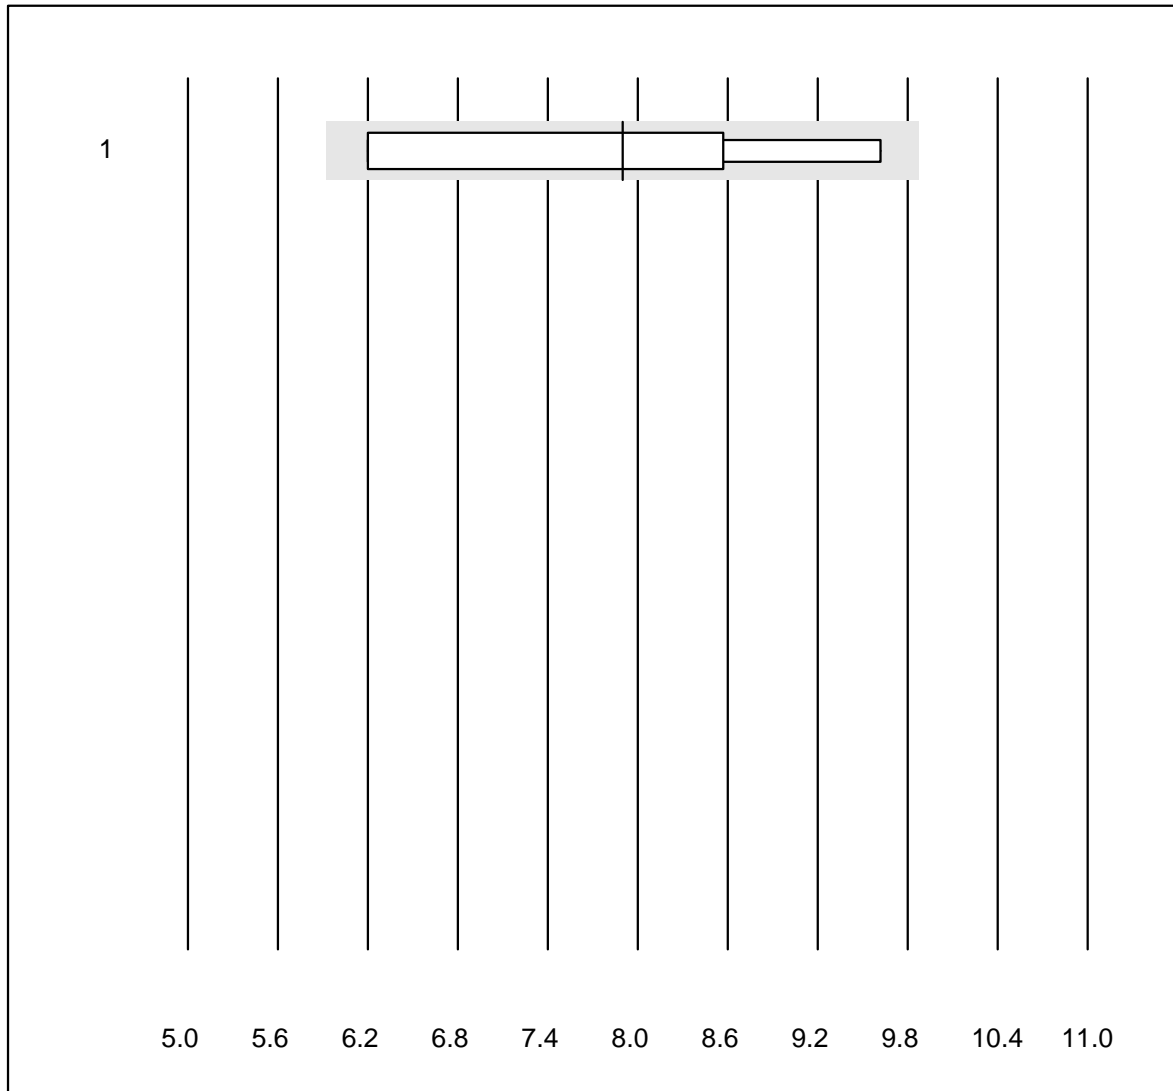


Tolérance MQ : 25 %

Leucocytes HS (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 PixCell HemoScreen	4	100.0	0.0	0.0	7.90	19.0	e*

## Thrombocytes HS

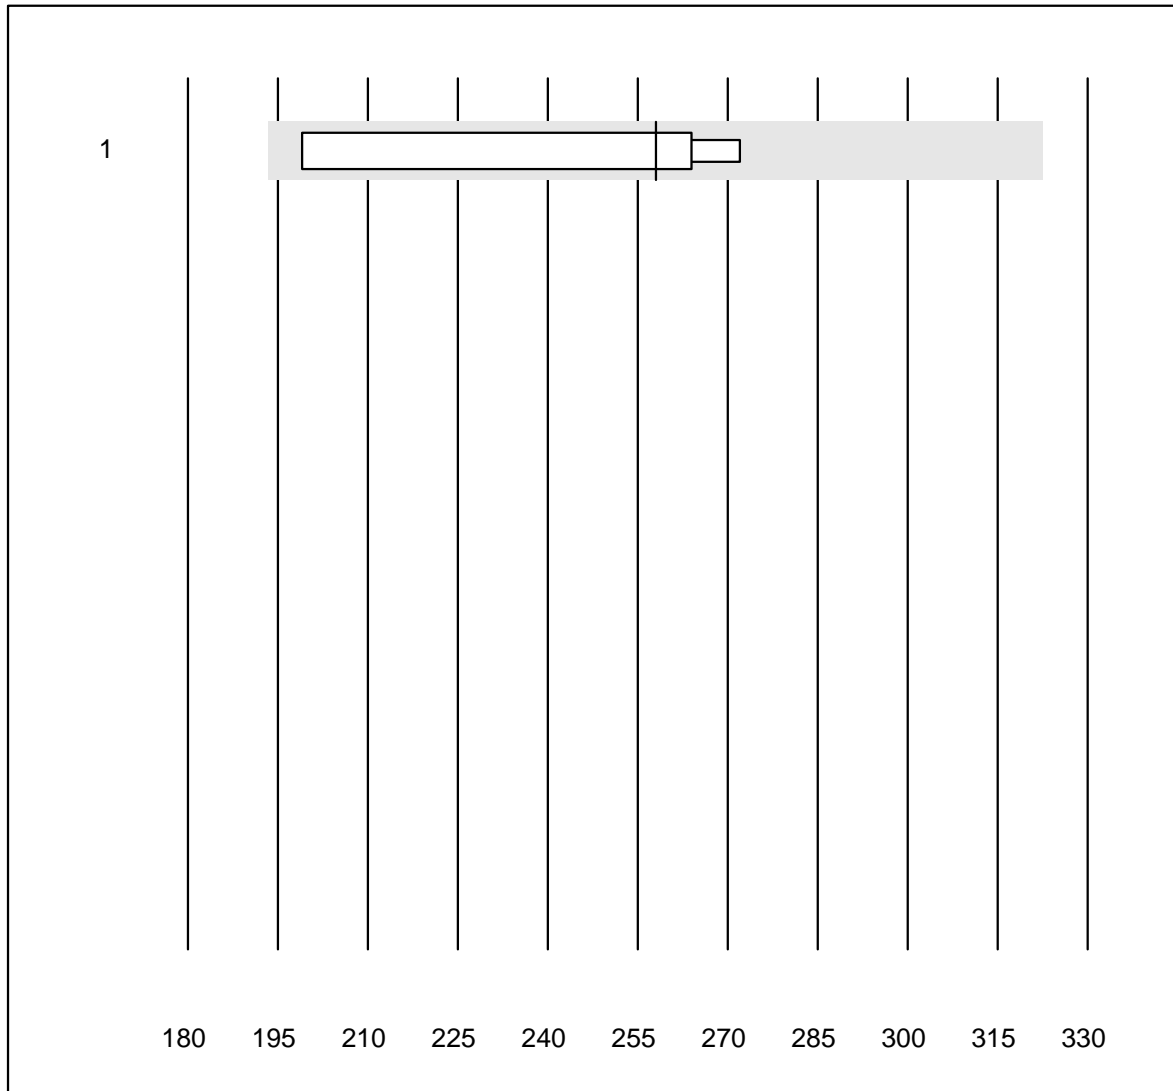


Tolérance MQ : 25 %

Thrombocytes HS (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 PixCell HemoScreen	4	100.0	0.0	0.0	258.0	13.3	e*

## CRP

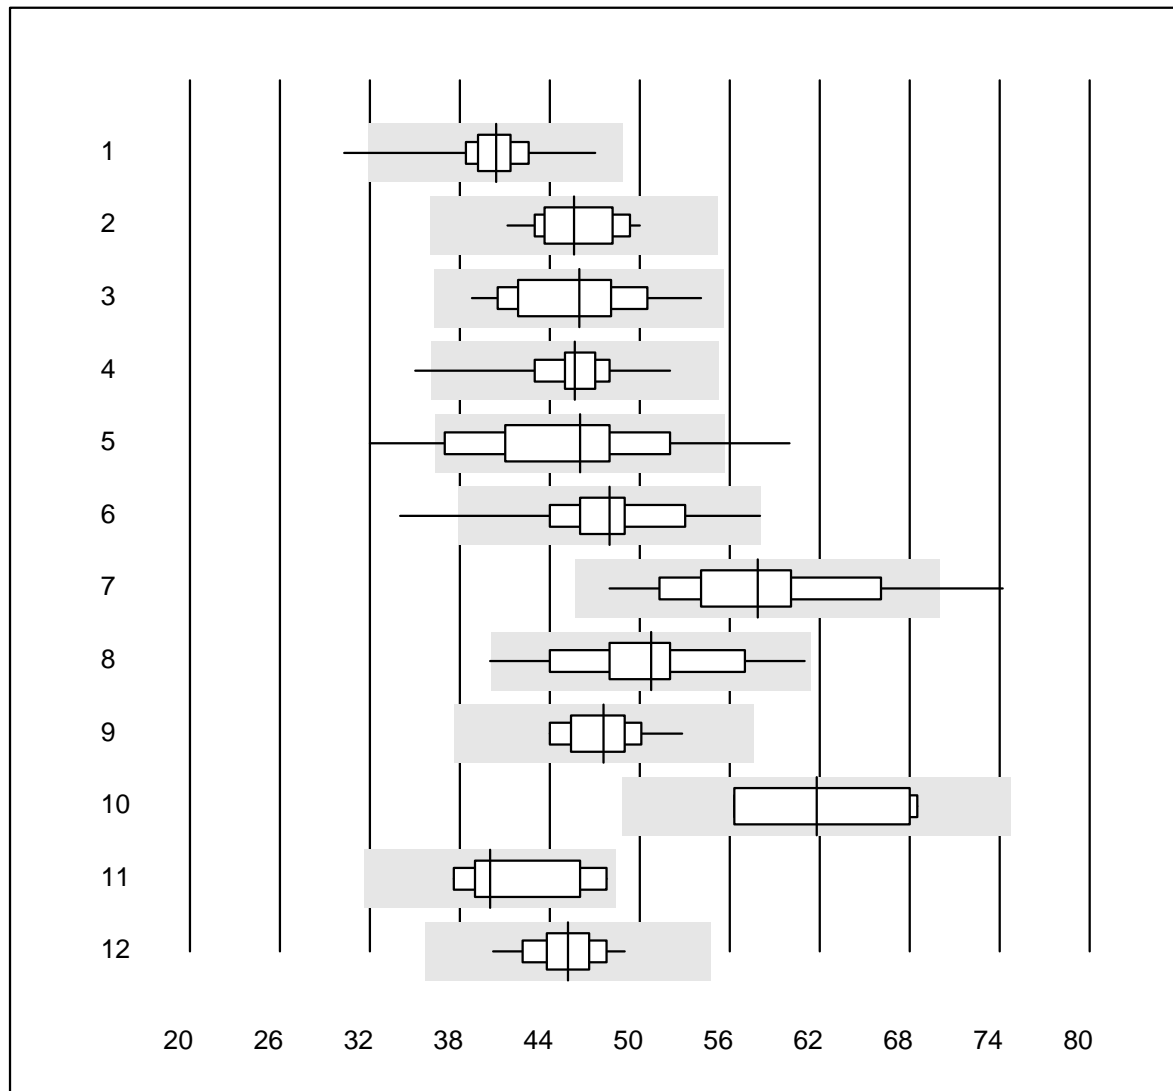


QUALAB Tolérance : 21 %

CRP (mg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas b101	314	99.1	0.3	0.6	40.4	4.6	e
2 Cobas	23	100.0	0.0	0.0	45.6	5.4	e
3 Turbidimétrie	14	85.7	0.0	14.3	46.0	9.3	e
4 Afinion	1198	99.3	0.4	0.3	45.7	4.8	e
5 NycoCard SingleTest-	93	81.7	10.8	7.5	46.0	12.8	e
6 Quick Read go	100	96.0	1.0	3.0	48.0	7.8	e
7 Eurolyser	89	82.0	4.5	13.5	57.9	9.5	e
8 Fuji Dri-Chem	17	88.2	5.9	5.9	50.8	9.5	e
9 Autolyser/DiaSys	12	91.7	0.0	8.3	47.6	5.6	e
10 Piccolo	6	66.7	0.0	33.3	61.8	9.0	e*
11 Nephelométrie	7	100.0	0.0	0.0	40.0	9.3	e*
12 Celltac chemi	47	100.0	0.0	0.0	45.2	4.5	e


## CRP

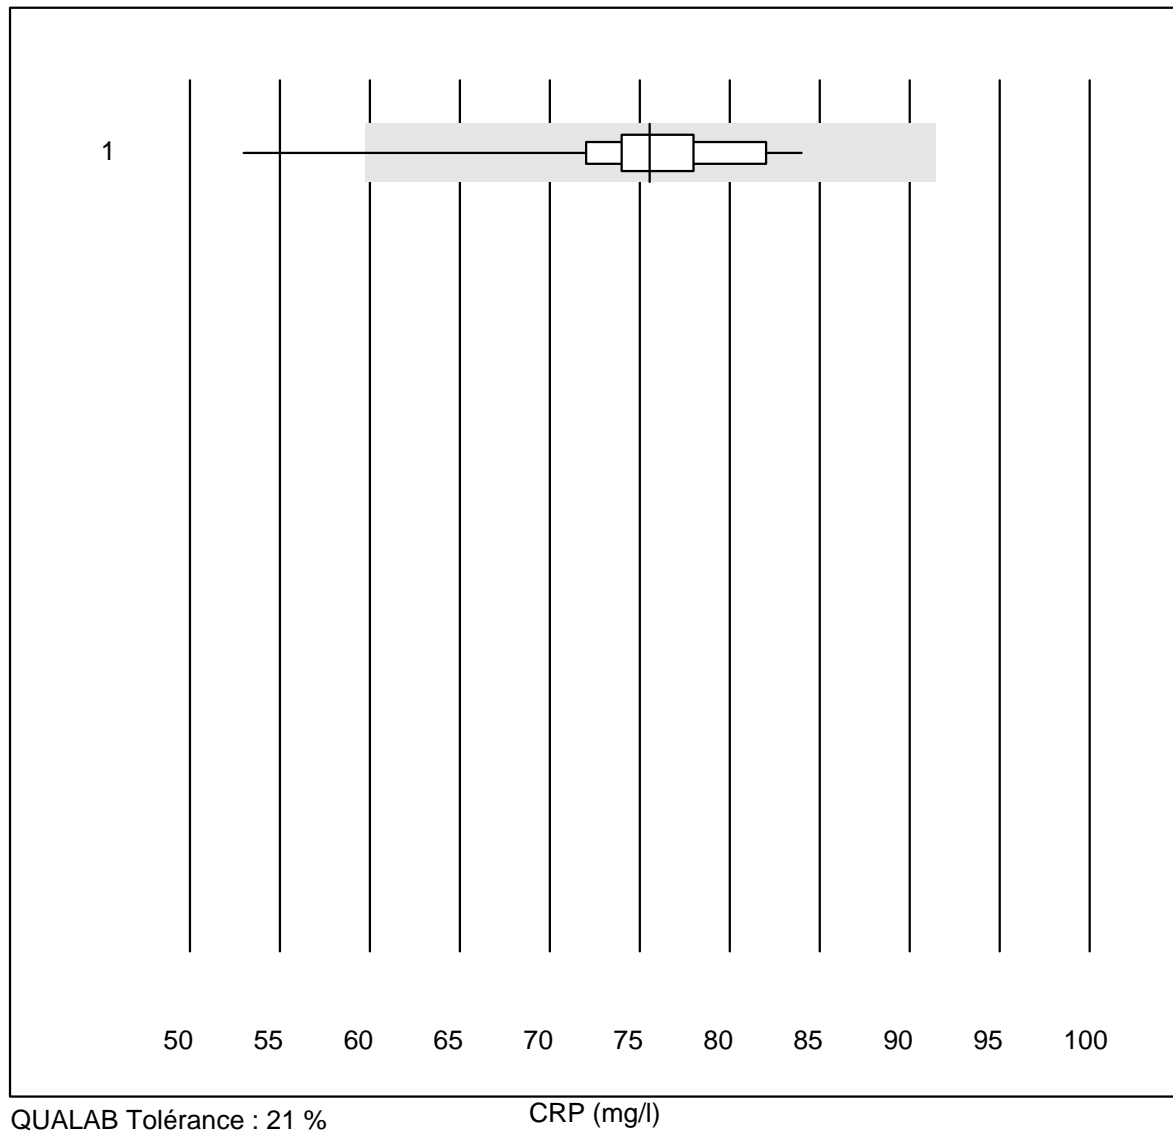

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 QuickRead (sang comp	27	88.9	3.7	7.4	75.6	7.7	e




## CRP

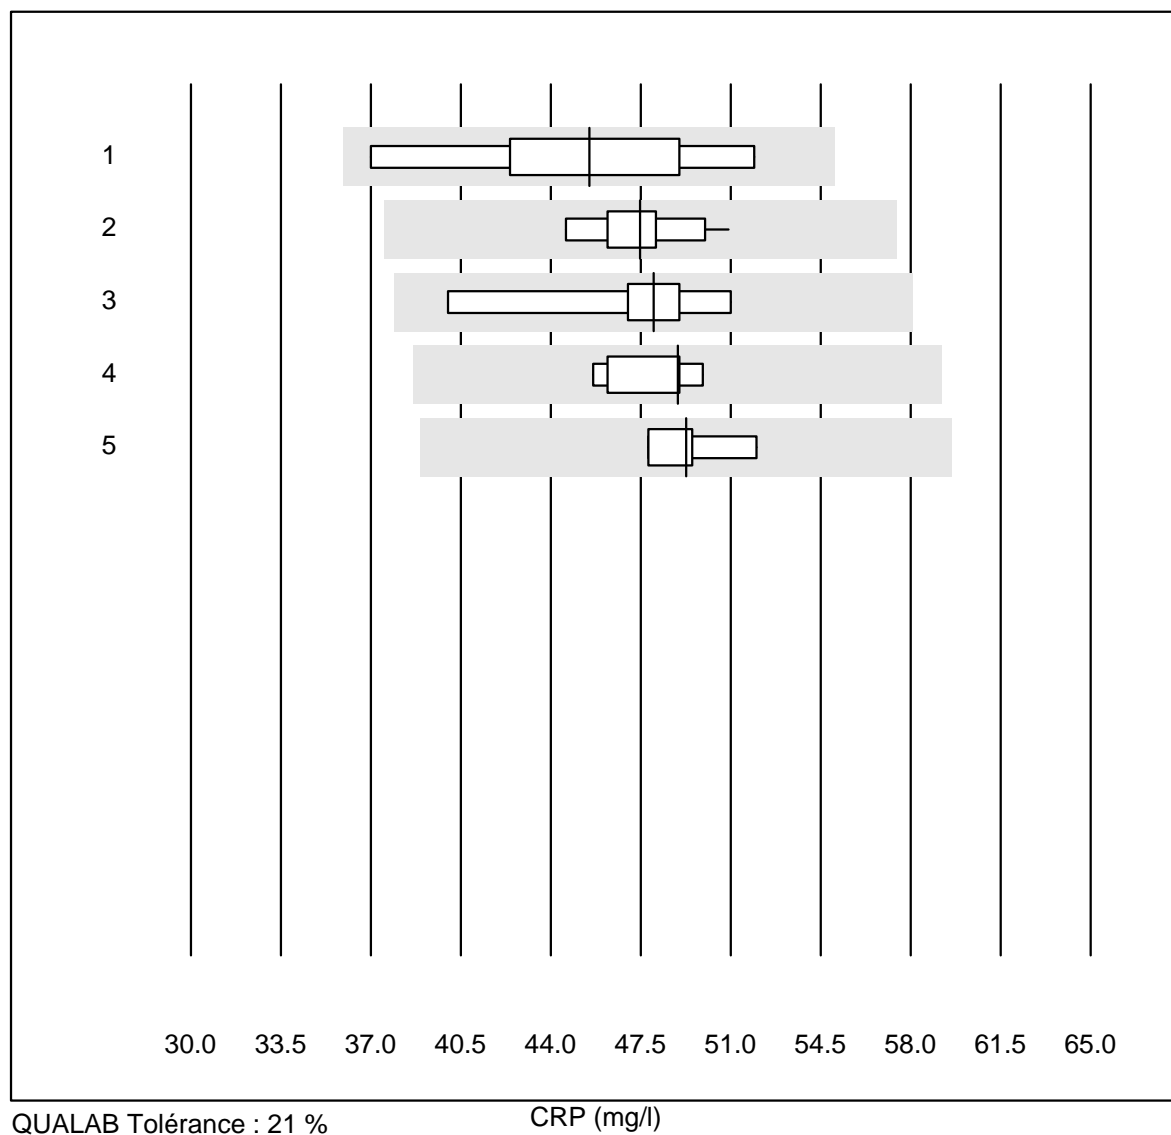

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Spinit	9	100.0	0.0	0.0	45.5	10.7	e*
2 Architect	10	100.0	0.0	0.0	47.5	4.2	e
3 AQT 90 FLEX	7	100.0	0.0	0.0	48.0	7.4	e*
4 Spotchem D-Concept	5	100.0	0.0	0.0	48.9	3.9	e
5 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	49.3	3.6	e

## IgG

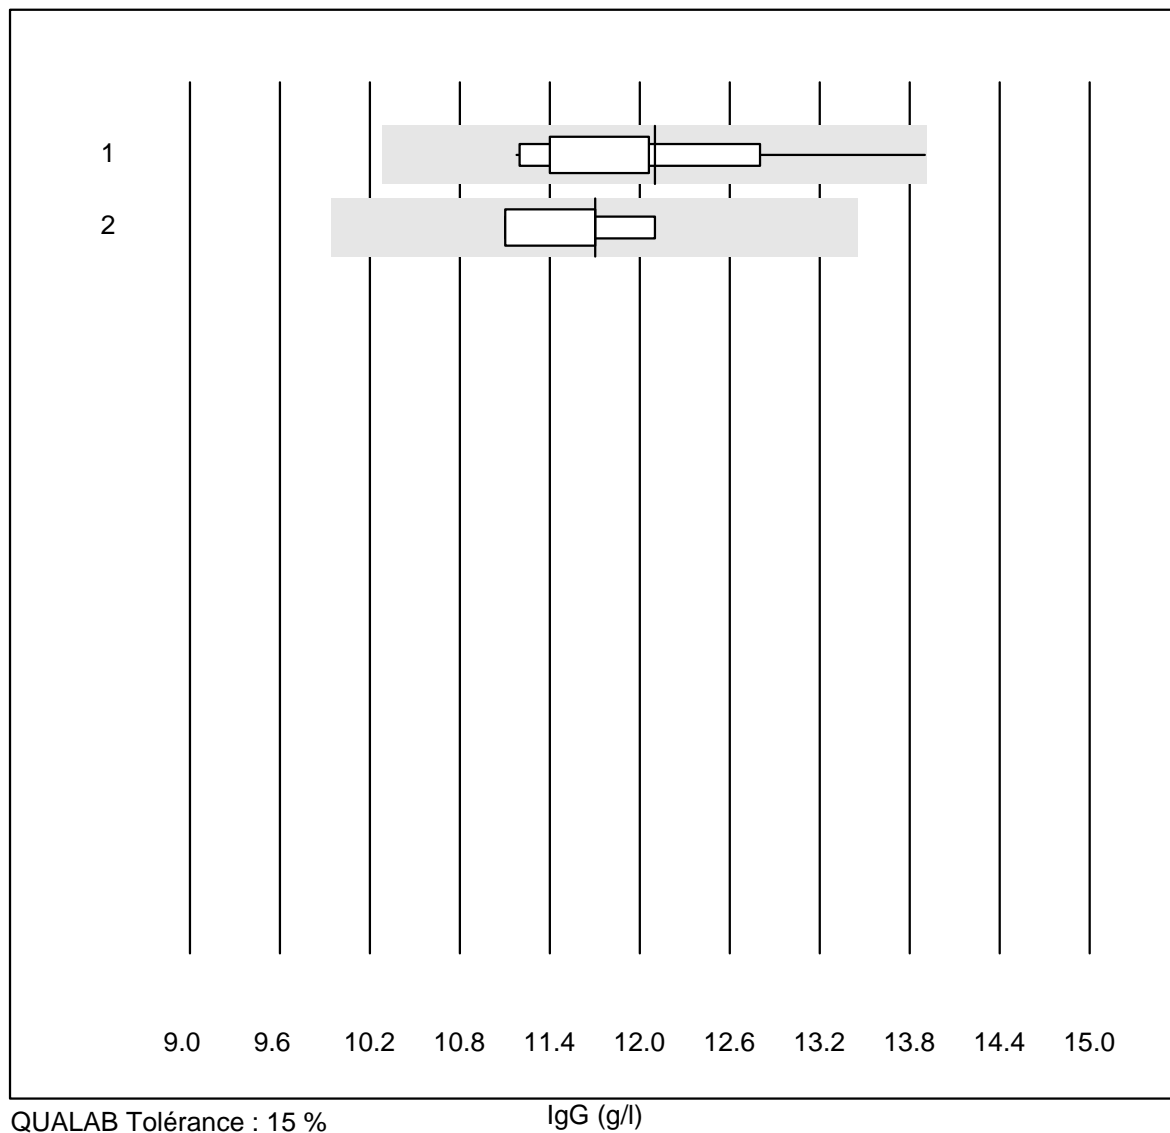


QUALAB Tolérance : 15 %

IgG (g/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Turbidimétrie	19	100.0	0.0	0.0	12.10	5.4	a
2 Néphélométrie	4	100.0	0.0	0.0	11.70	3.6	e

## IgA

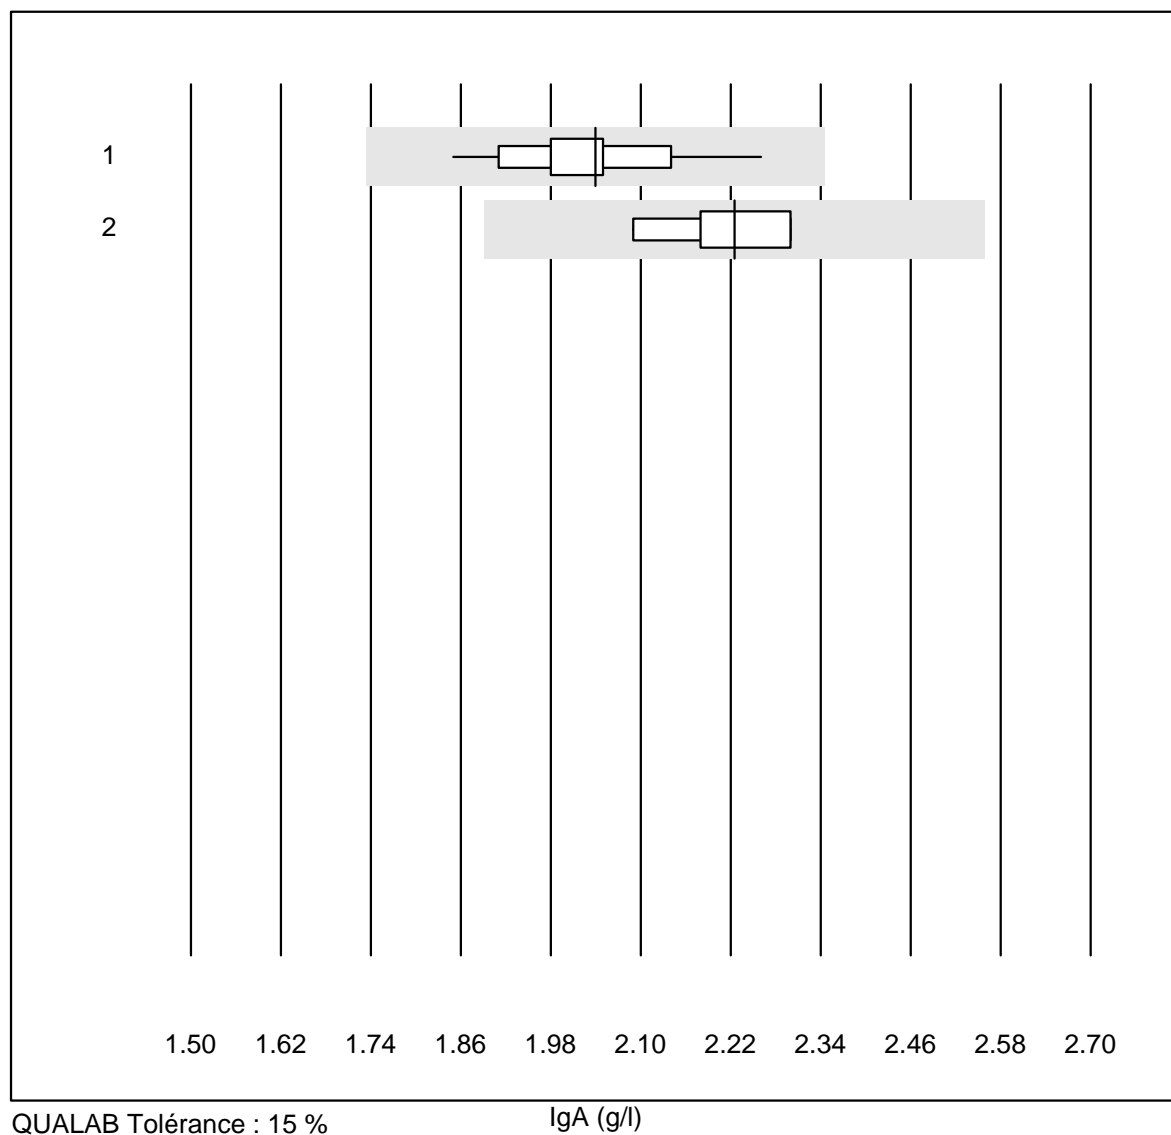


QUALAB Tolérance : 15 %

IgA (g/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Turbidimétrie	17	100.0	0.0	0.0	2.04	4.5	e
2 Néphélométrie	5	100.0	0.0	0.0	2.23	4.1	e*

# IgM

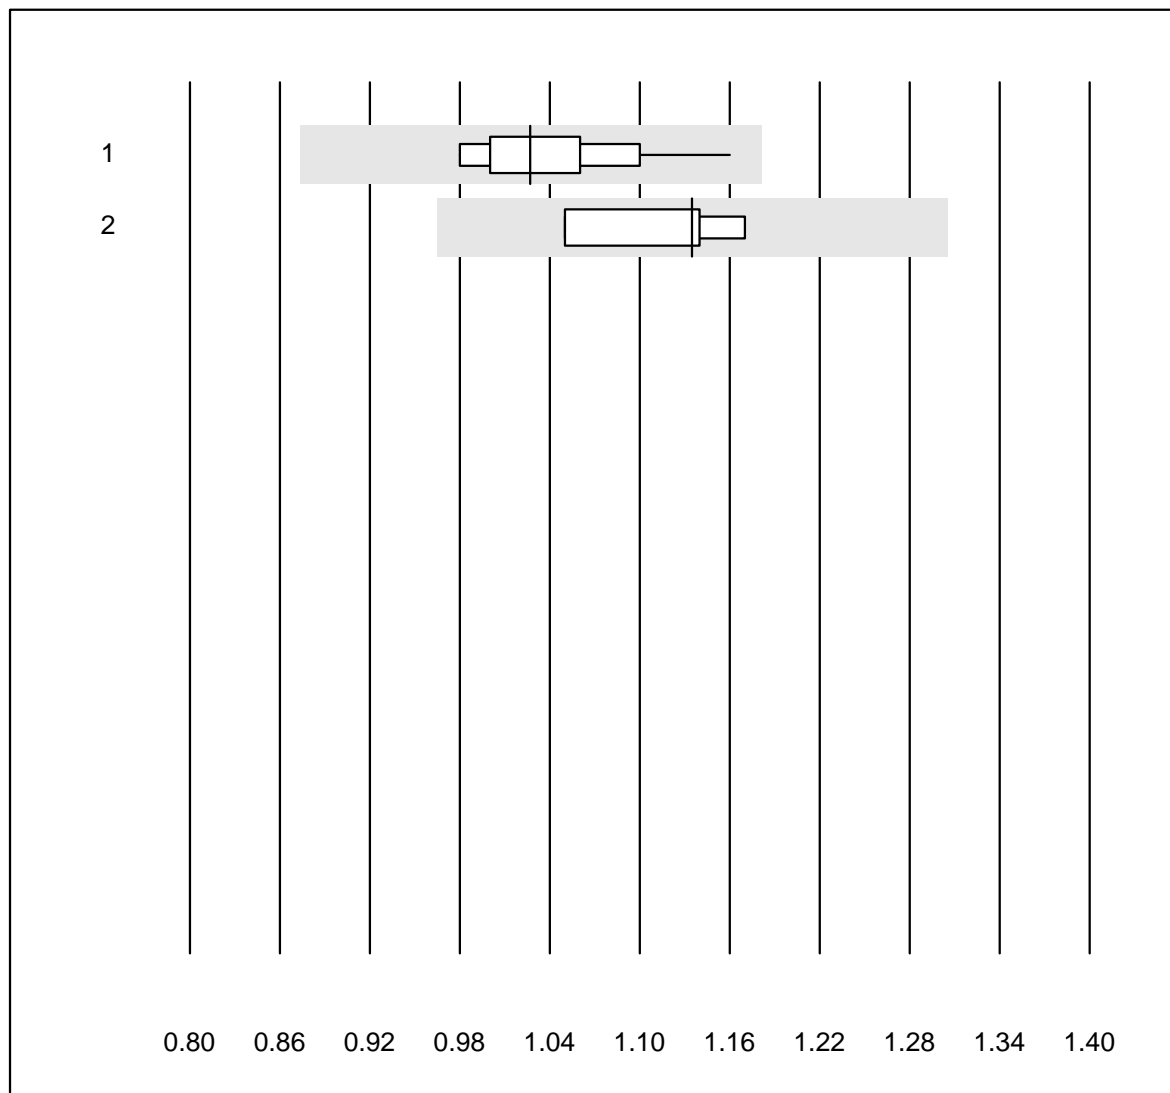


QUALAB Tolérance : 15 %

IgM (g/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Turbidimétrie	18	100.0	0.0	0.0	1.03	4.6	e
2 Néphélométrie	4	100.0	0.0	0.0	1.14	4.6	e*

# IgE

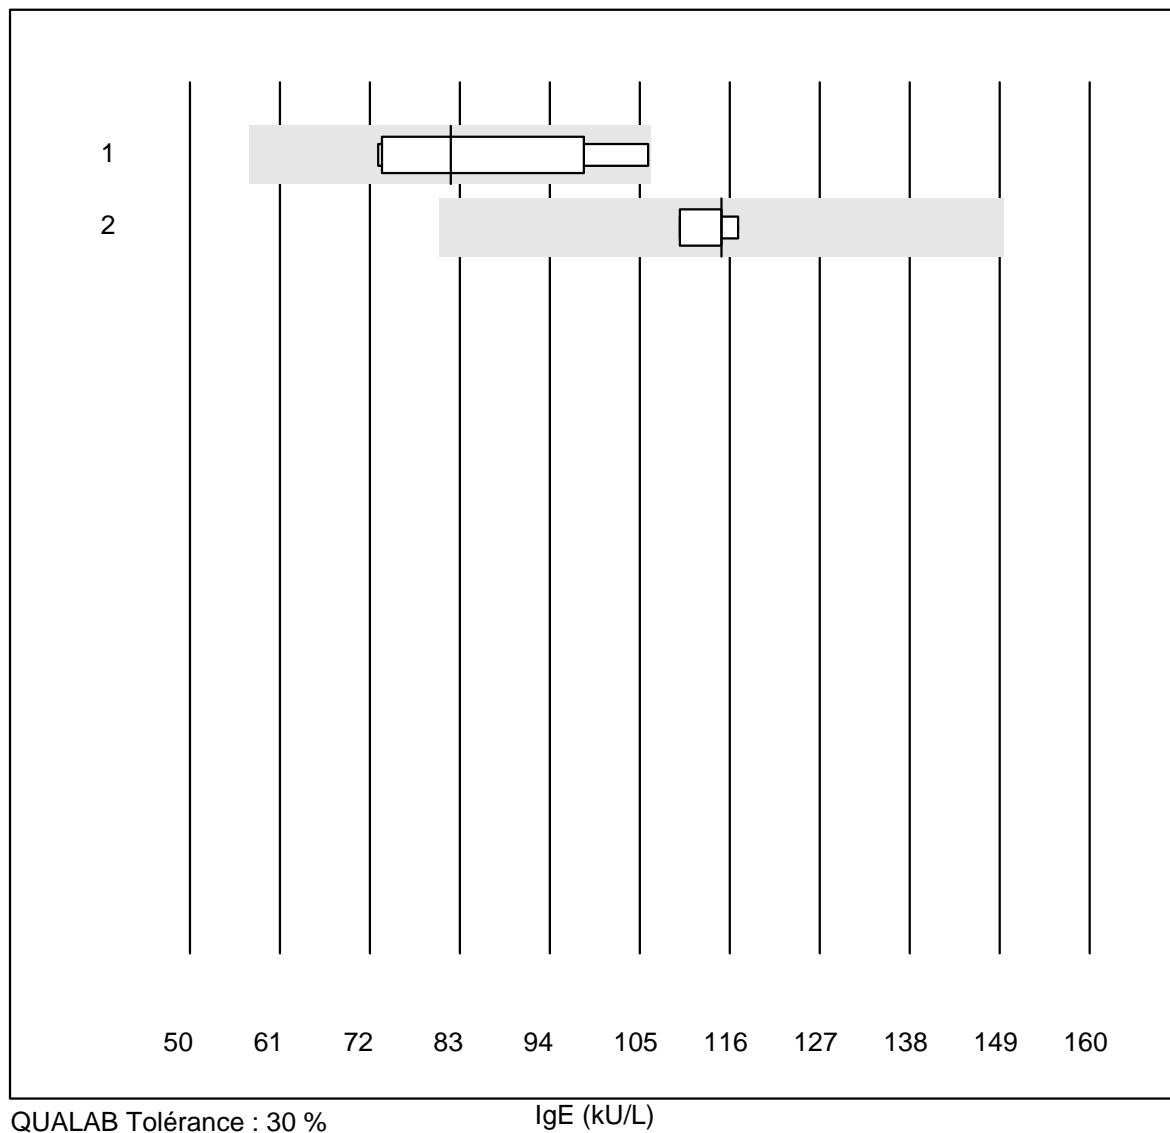


QUALAB Tolérance : 30 %

IgE (kU/L)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	82	15.9	e*
2 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	115	2.6	e

## Alpha-1-Antitrypsine

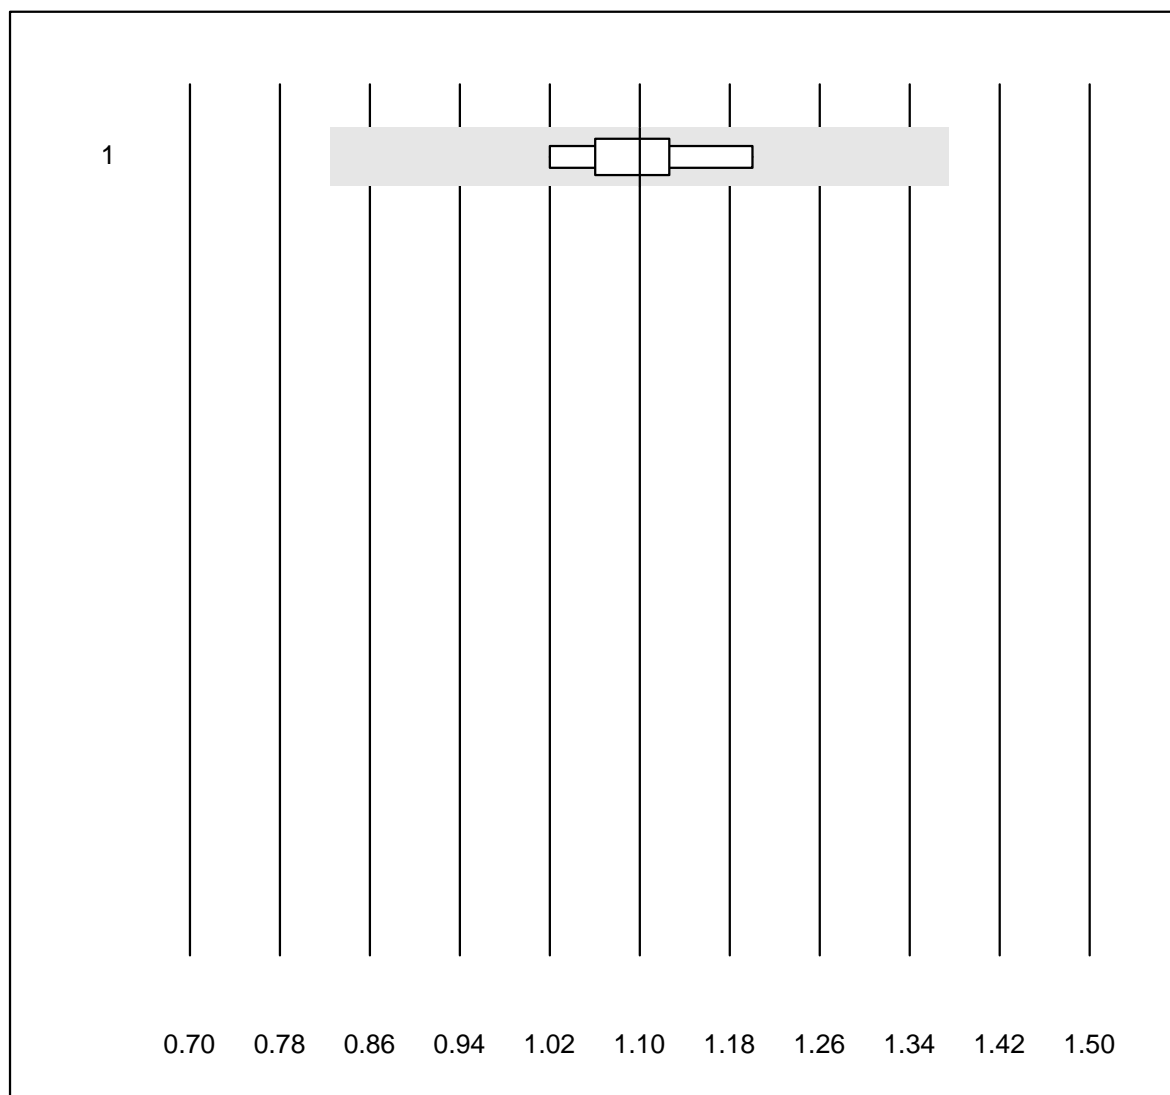


Tolérance MQ : 25 %

Alpha-1-Antitrypsine (g/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	1.10	5.1	e

## Anti-Streptolysine-Anticorps

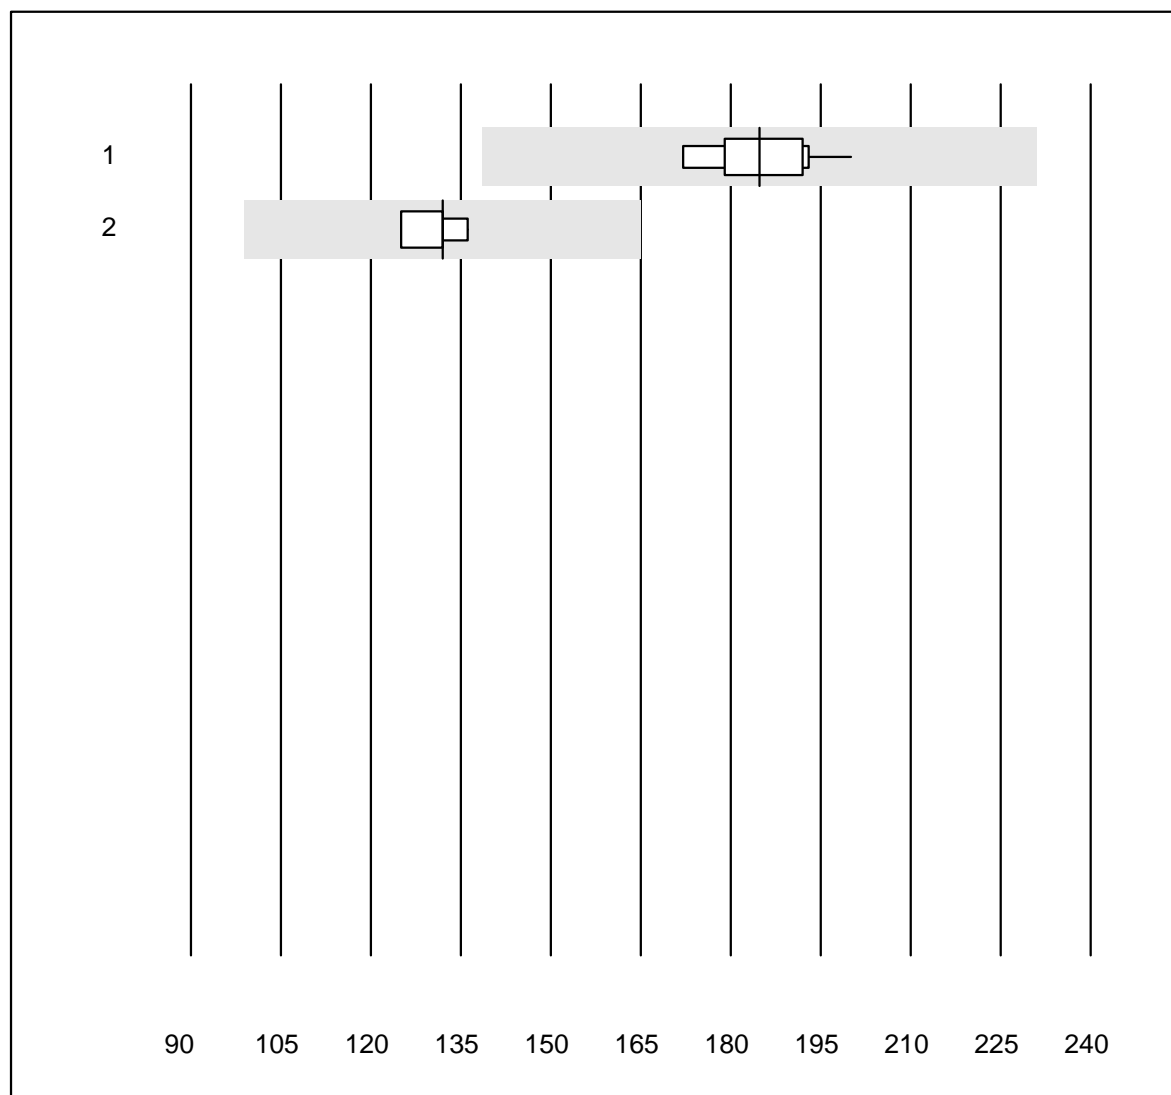


Tolérance MQ : 25 %

Anti-Streptolysine-Anticorps (kIU/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	11	100.0	0.0	0.0	185	4.7	e
2 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	132	3.5	e

## Complément C3

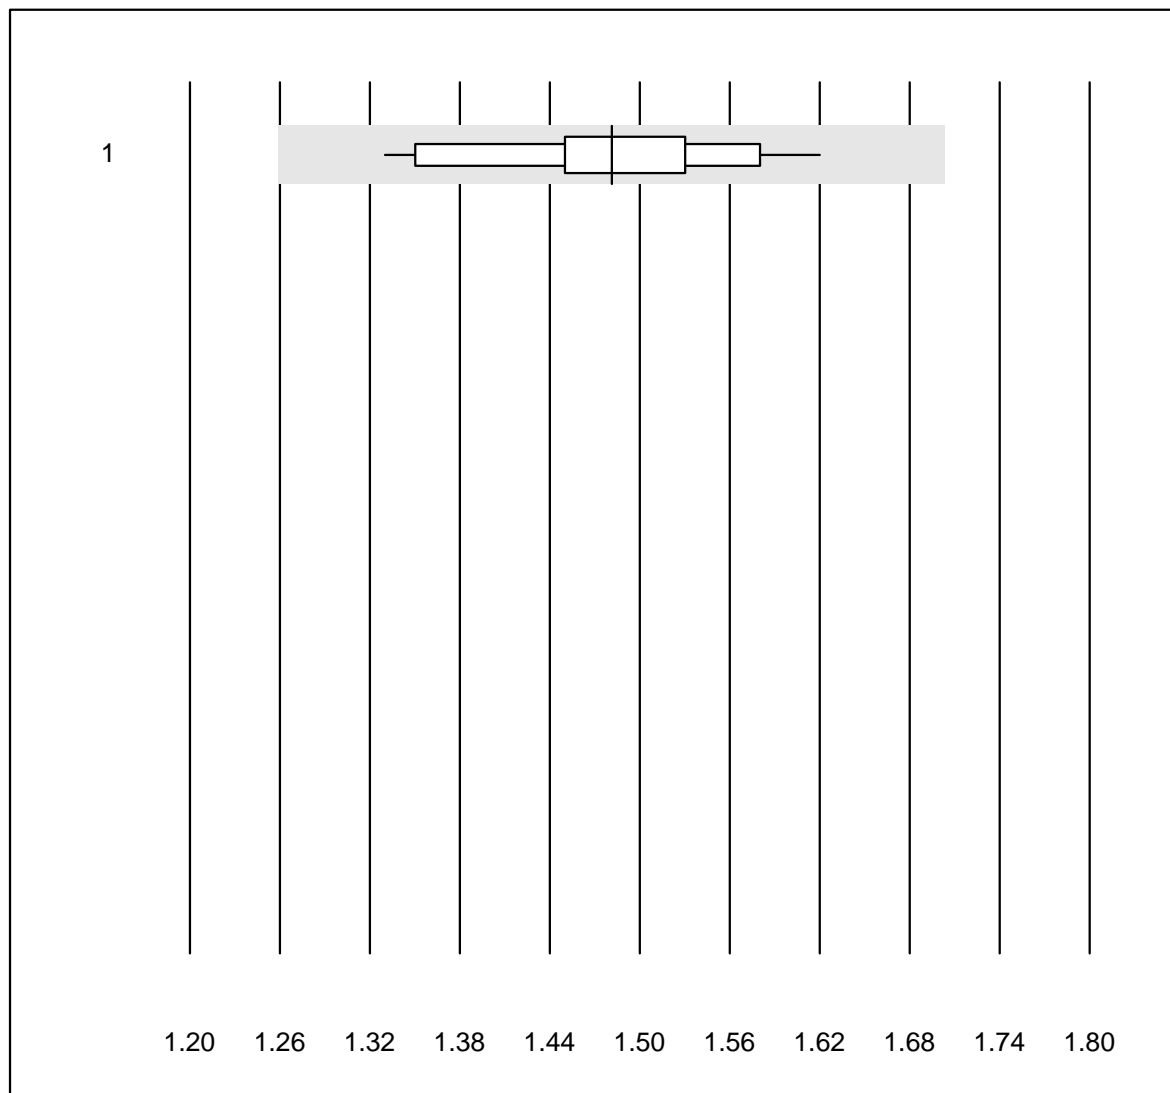


QUALAB Tolérance : 15 %

Complément C3 (g/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	18	100.0	0.0	0.0	1.48	5.2	e




## Complément C4

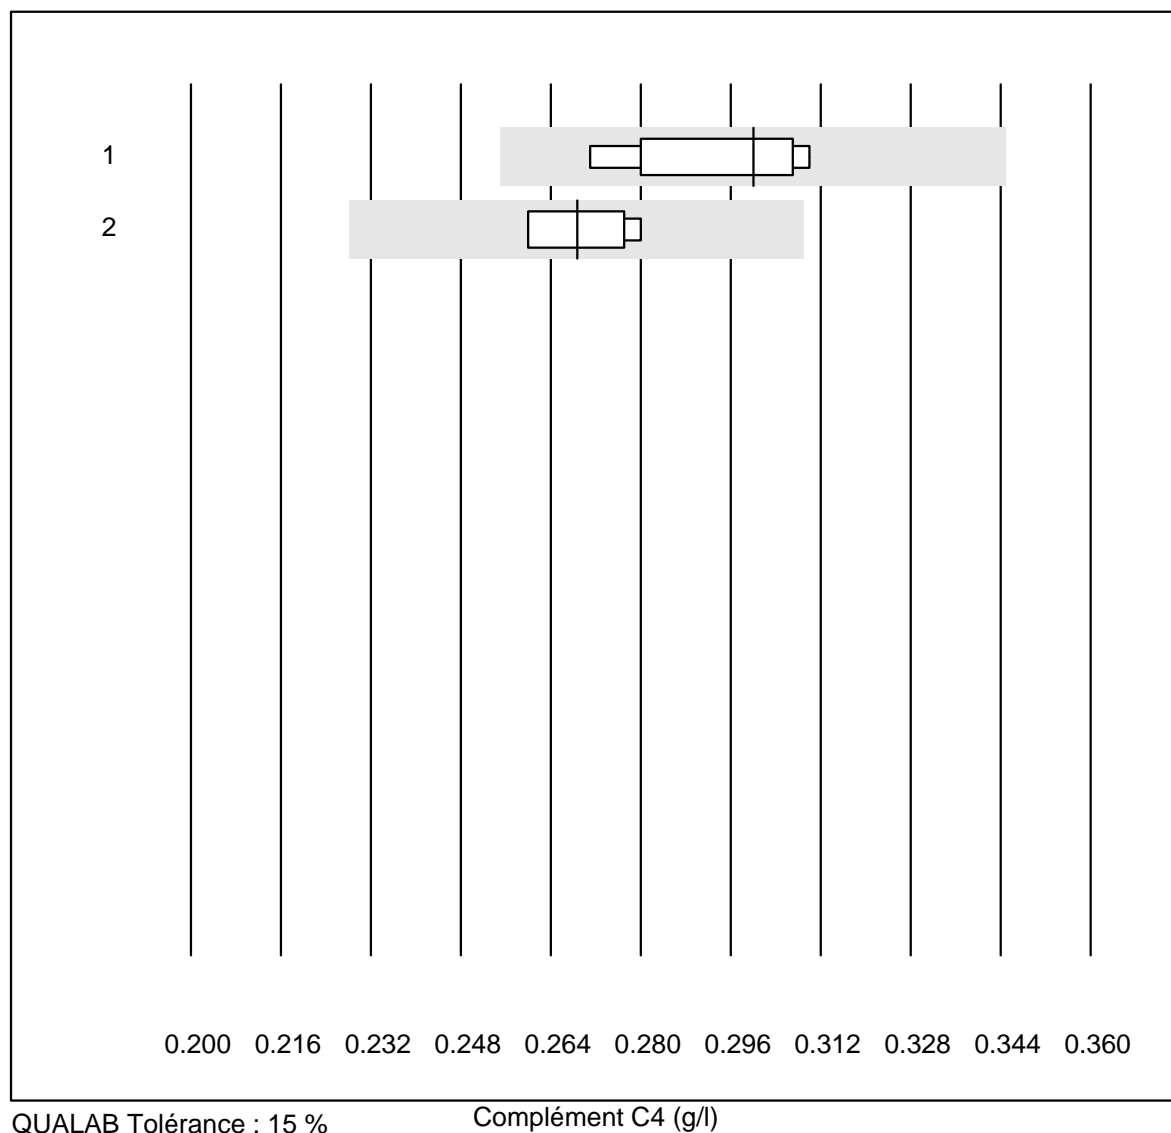


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Alinity	6	100.0	0.0	0.0	0.30	5.3	e*
2 toutes les méthodes	11	100.0	0.0	0.0	0.27	3.0	e

## Haptoglobine

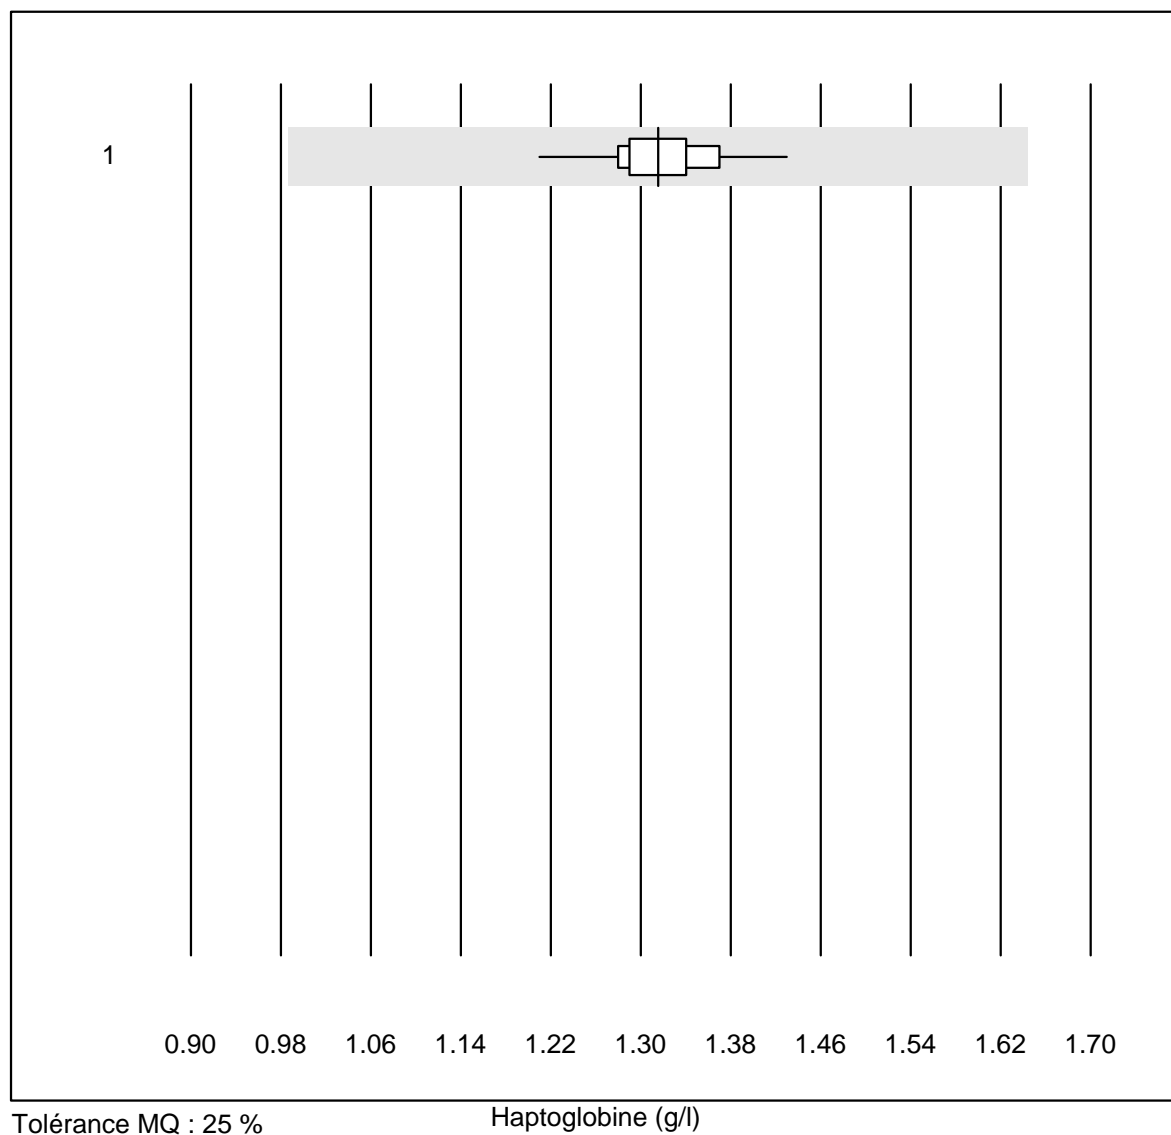

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	22	100.0	0.0	0.0	1.32	3.5	e

## Transferrine

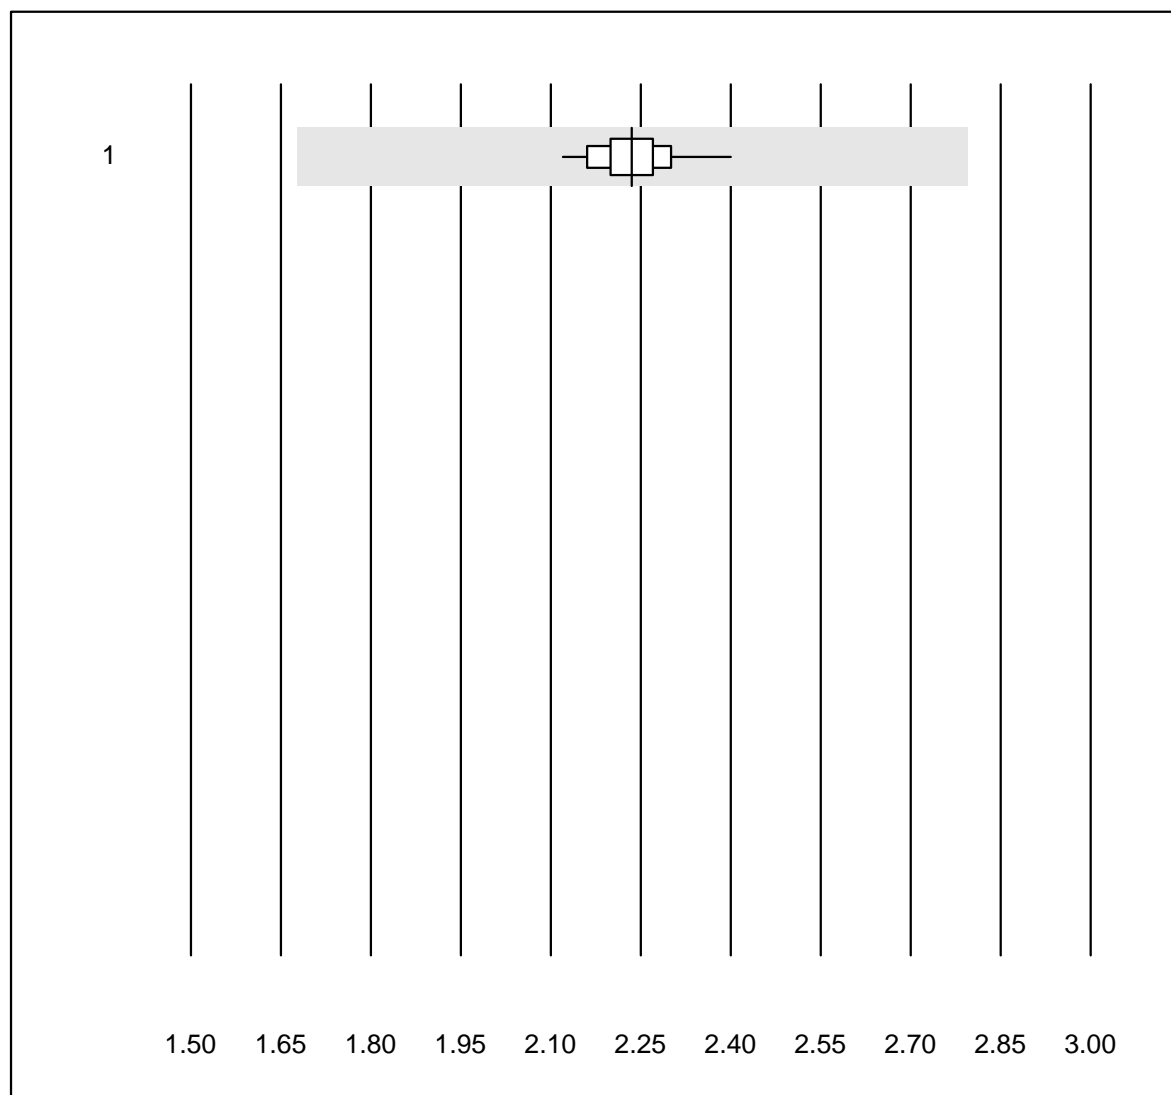


Tolérance MQ : 25 %

Transferrine (g/l)


No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	25	100.0	0.0	0.0	2.24	2.7	e

## Bêta-2 microglobuline

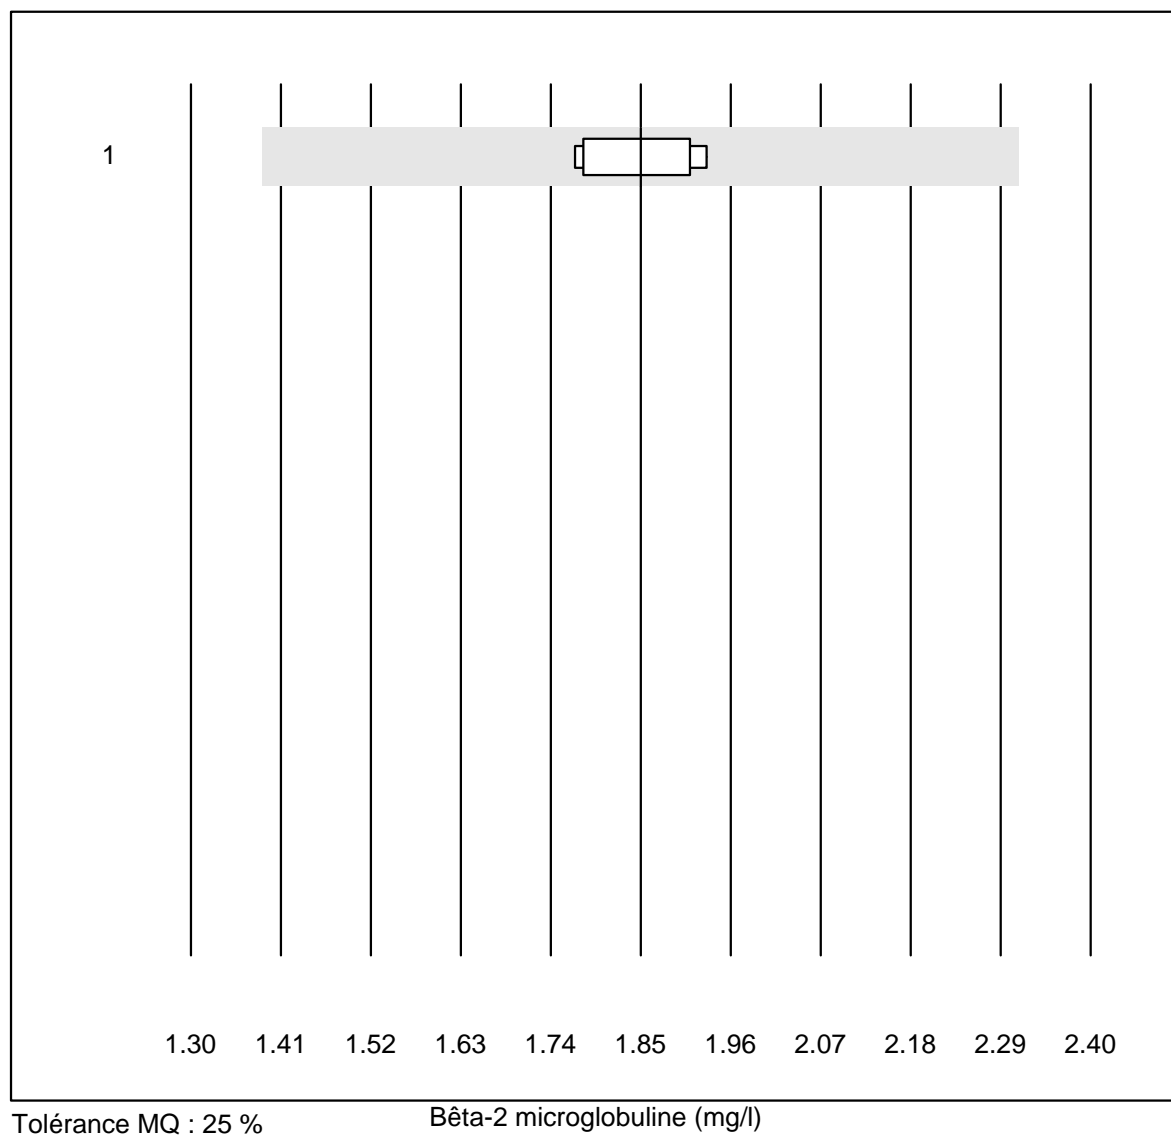


No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	1.85	3.9	e

## Facteur rhumatoïde

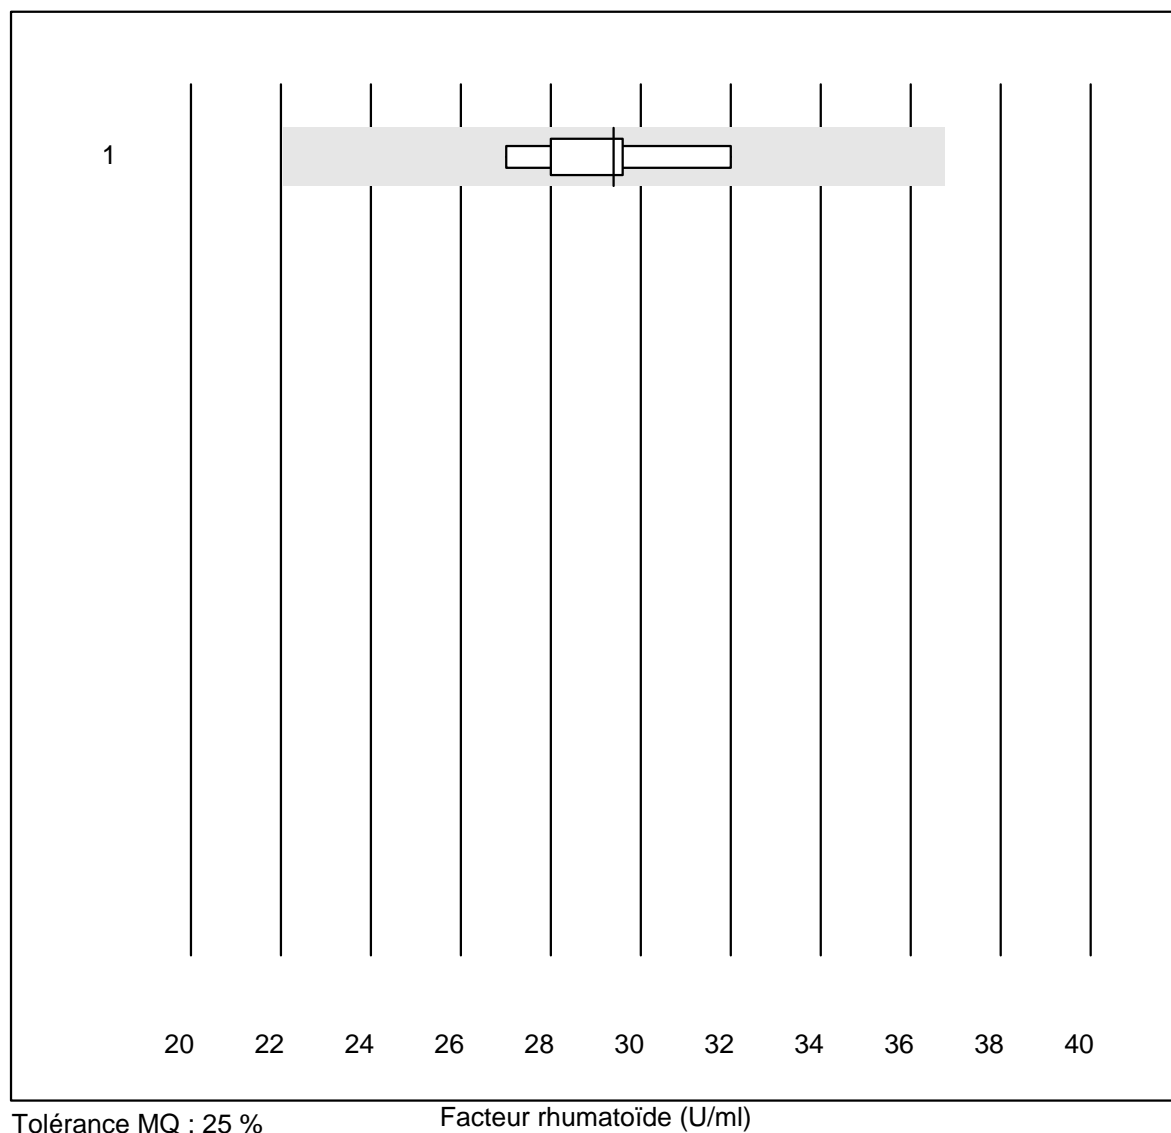


No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Architect	5	100.0	0.0	0.0	29.4	6.5	e

## Céruleplasmine

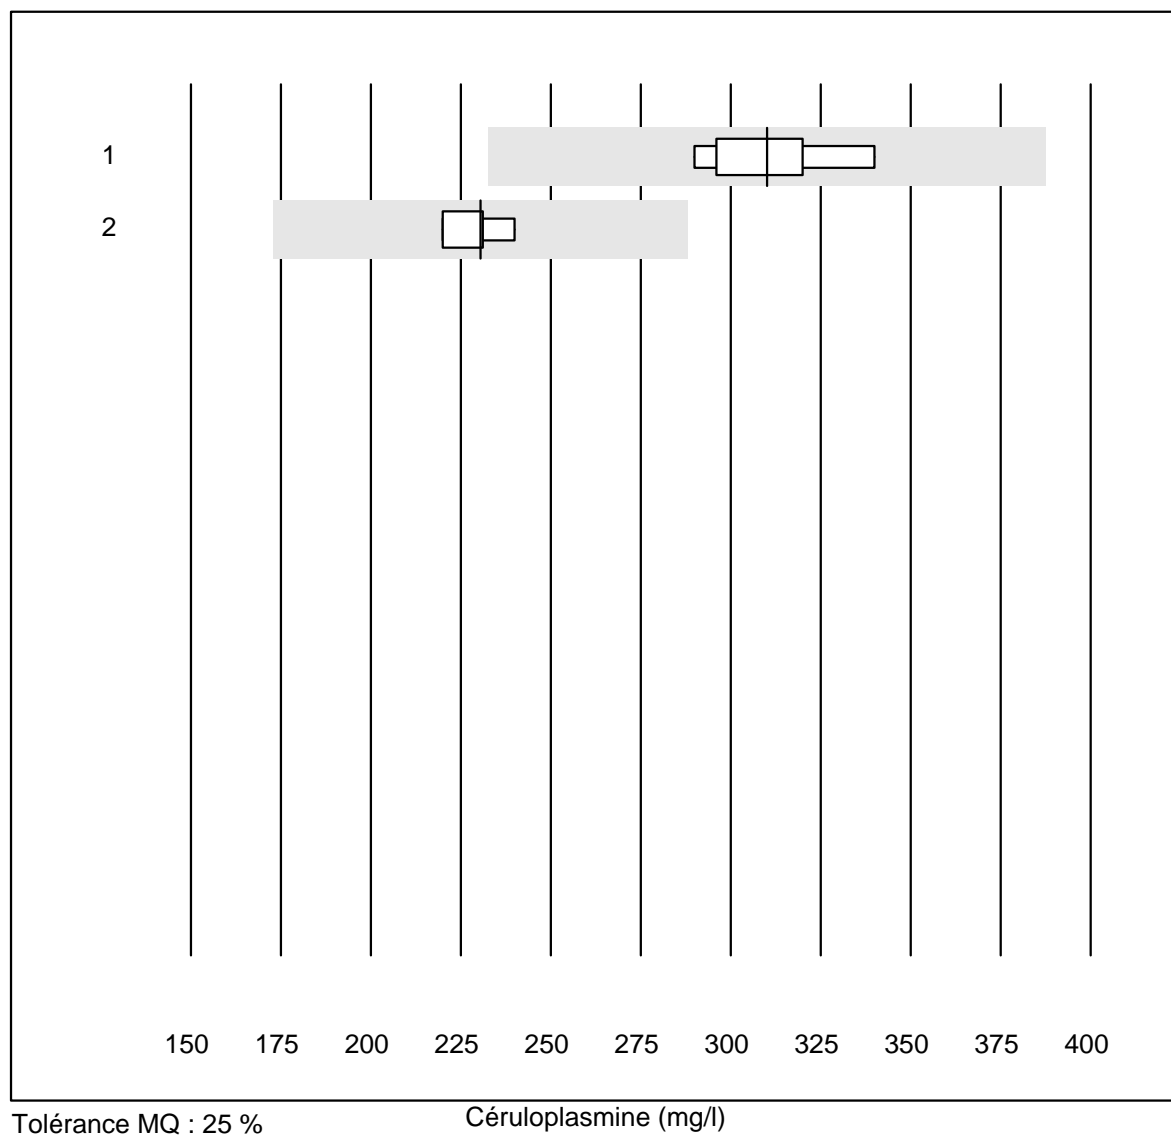


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Siemens	5	100.0	0.0	0.0	310.00	6.4	e
2 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	230.50	3.6	e

## Pré-albumine

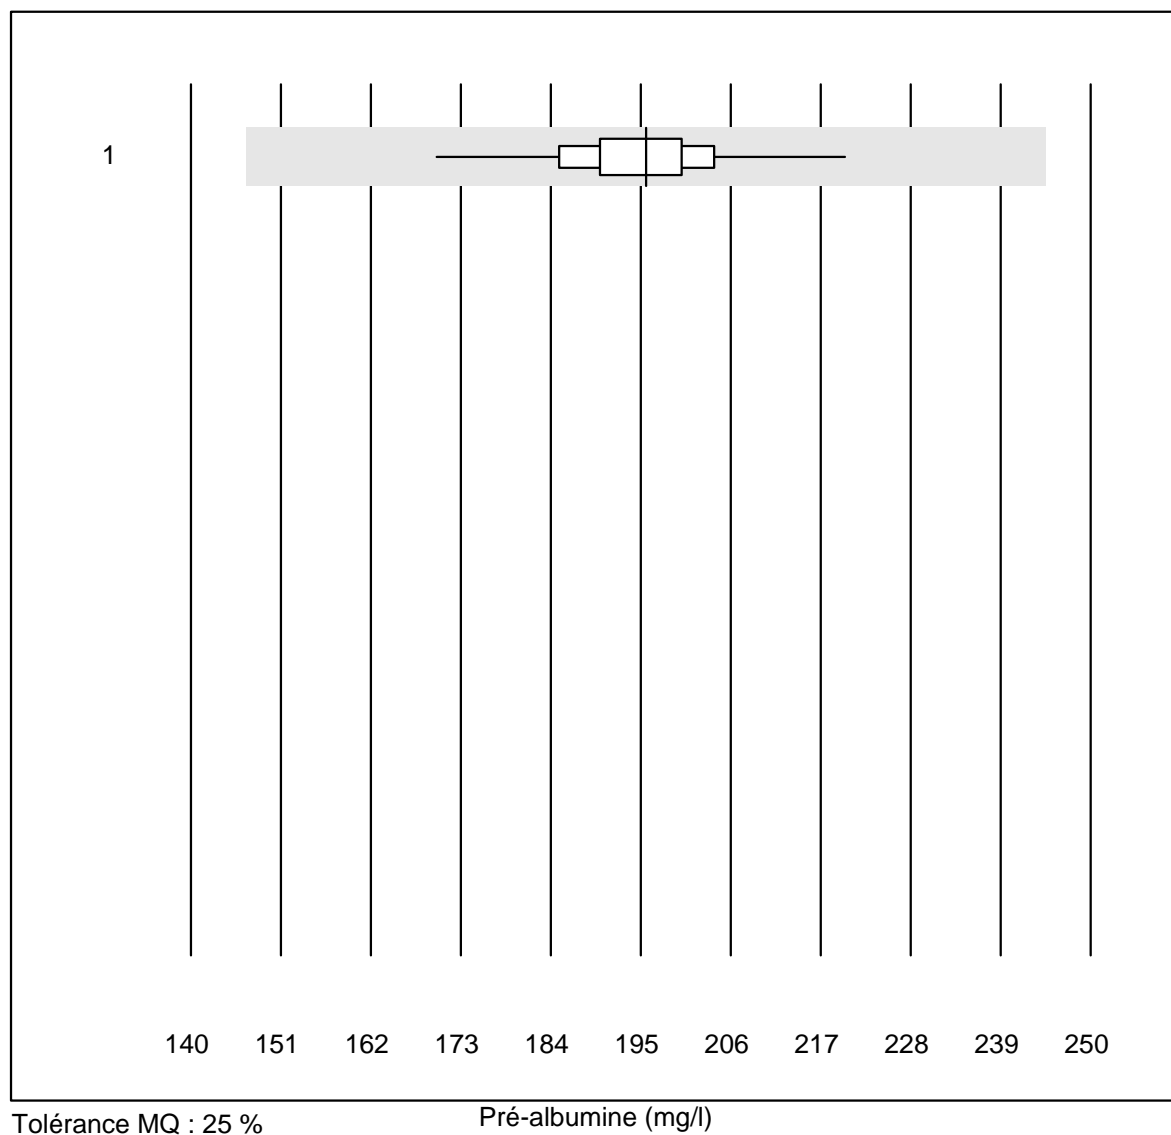

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	15	100.0	0.0	0.0	195.6	5.5	e

## Récepteur soluble de la transferrine

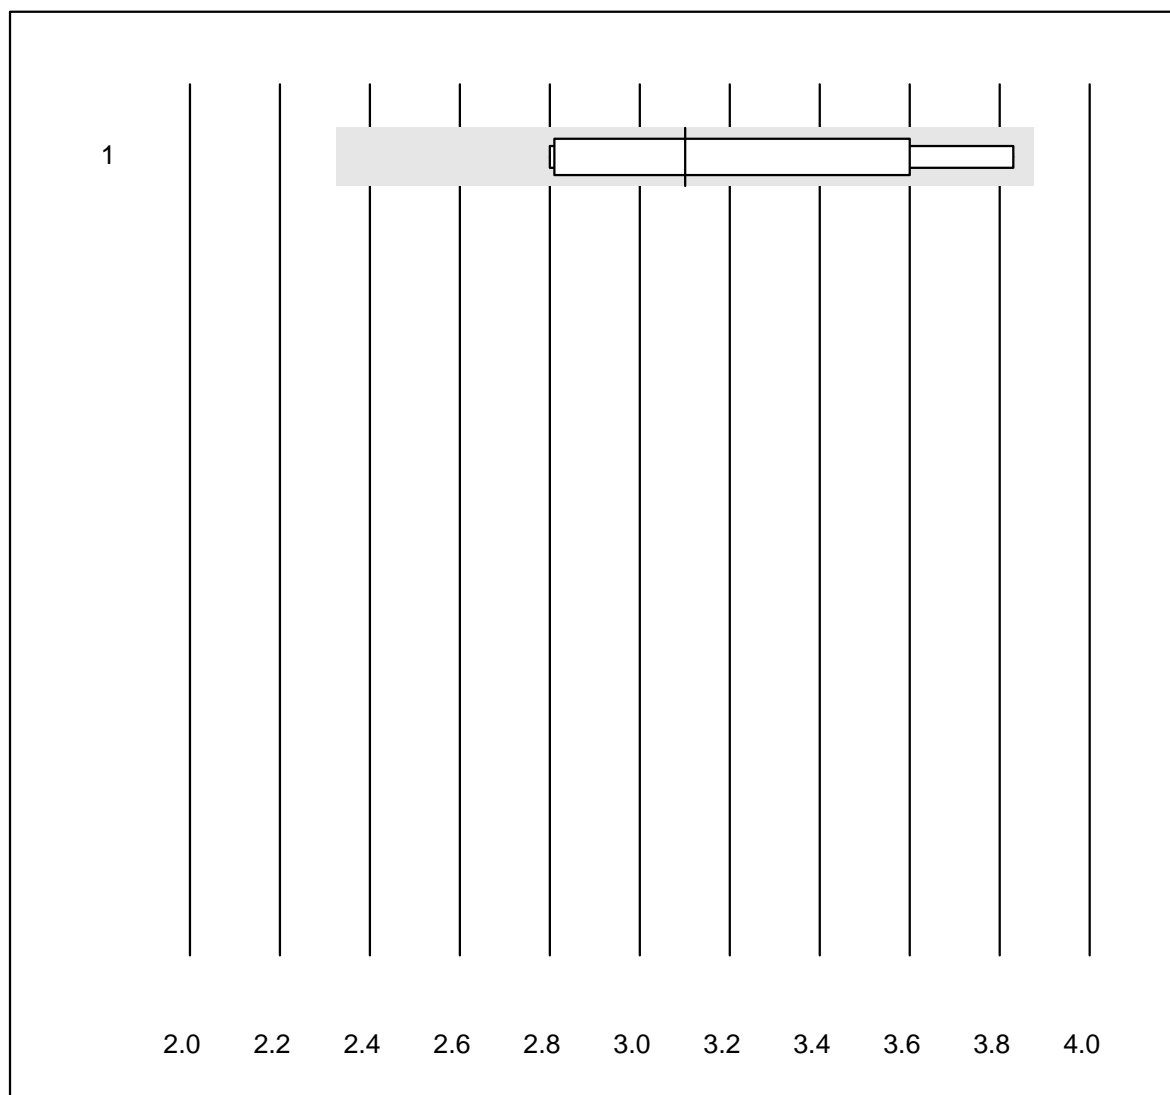


Tolérance MQ : 25 %

Récepteur soluble de la transferrine (mg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	3.1	14.4	a




## chaînes légères libres Kappa

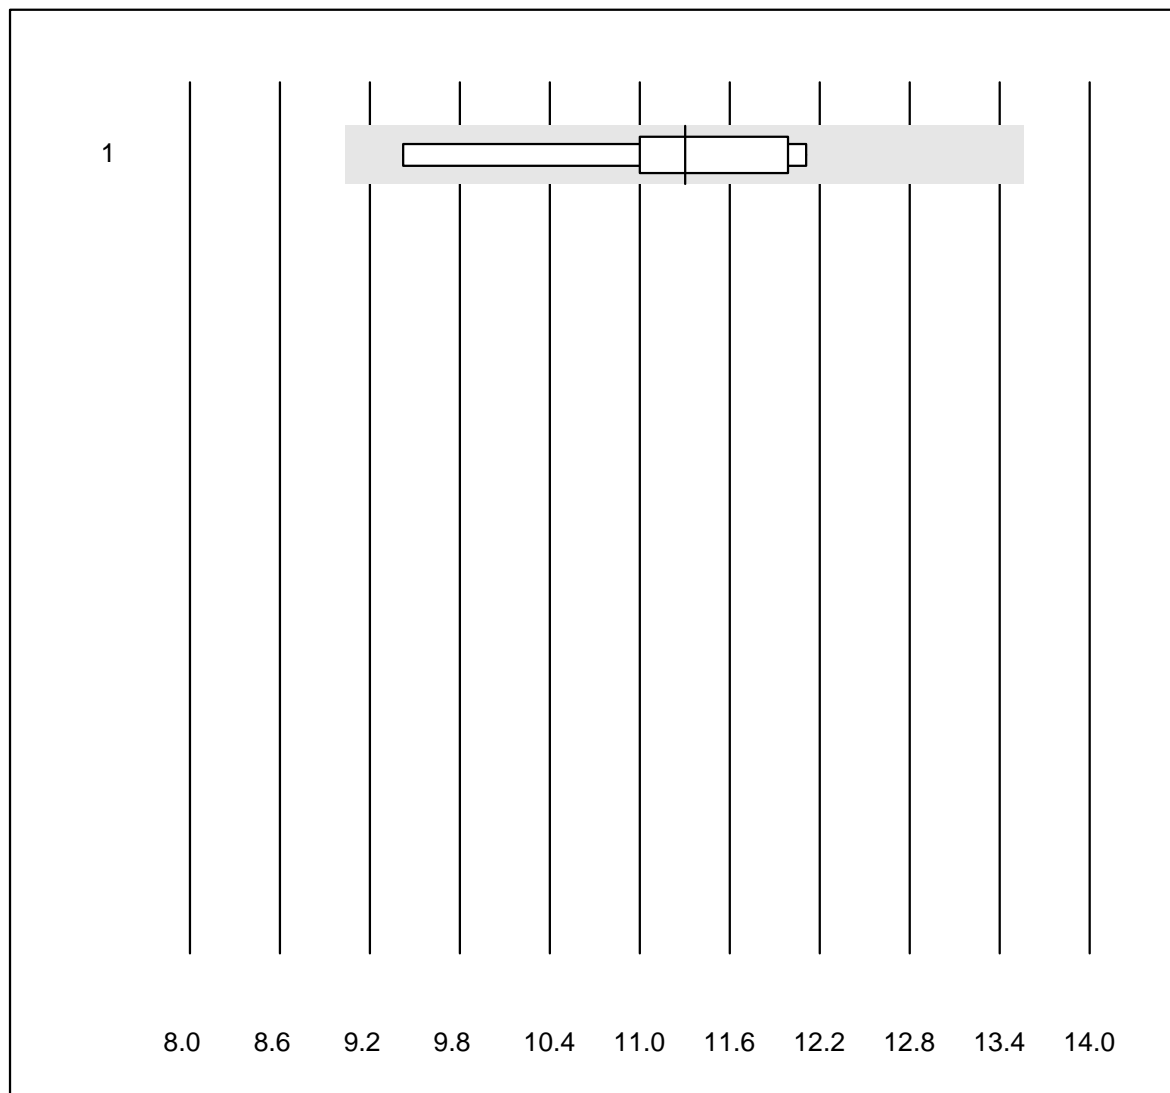

QUALAB Tolérance : 20 % chaînes légères libres Kappa (mg/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	8	100.0	0.0	0.0	11	7.7	e*

## chaîne légère Lambda

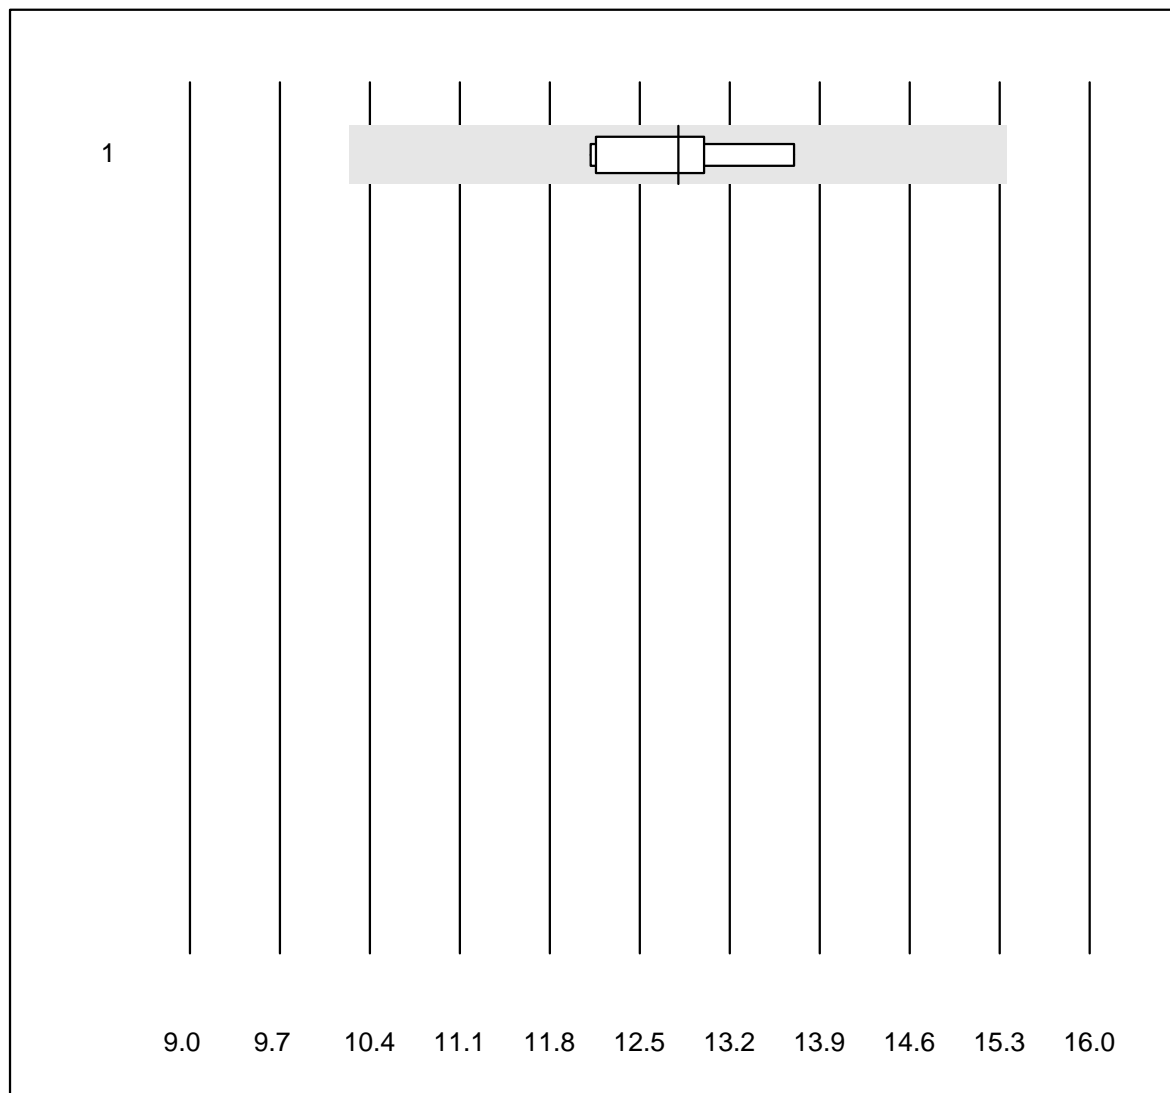


QUALAB Tolérance : 20 %

chaîne légère Lambda (mg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	8	100.0	0.0	0.0	13	4.3	e

# CRP HS

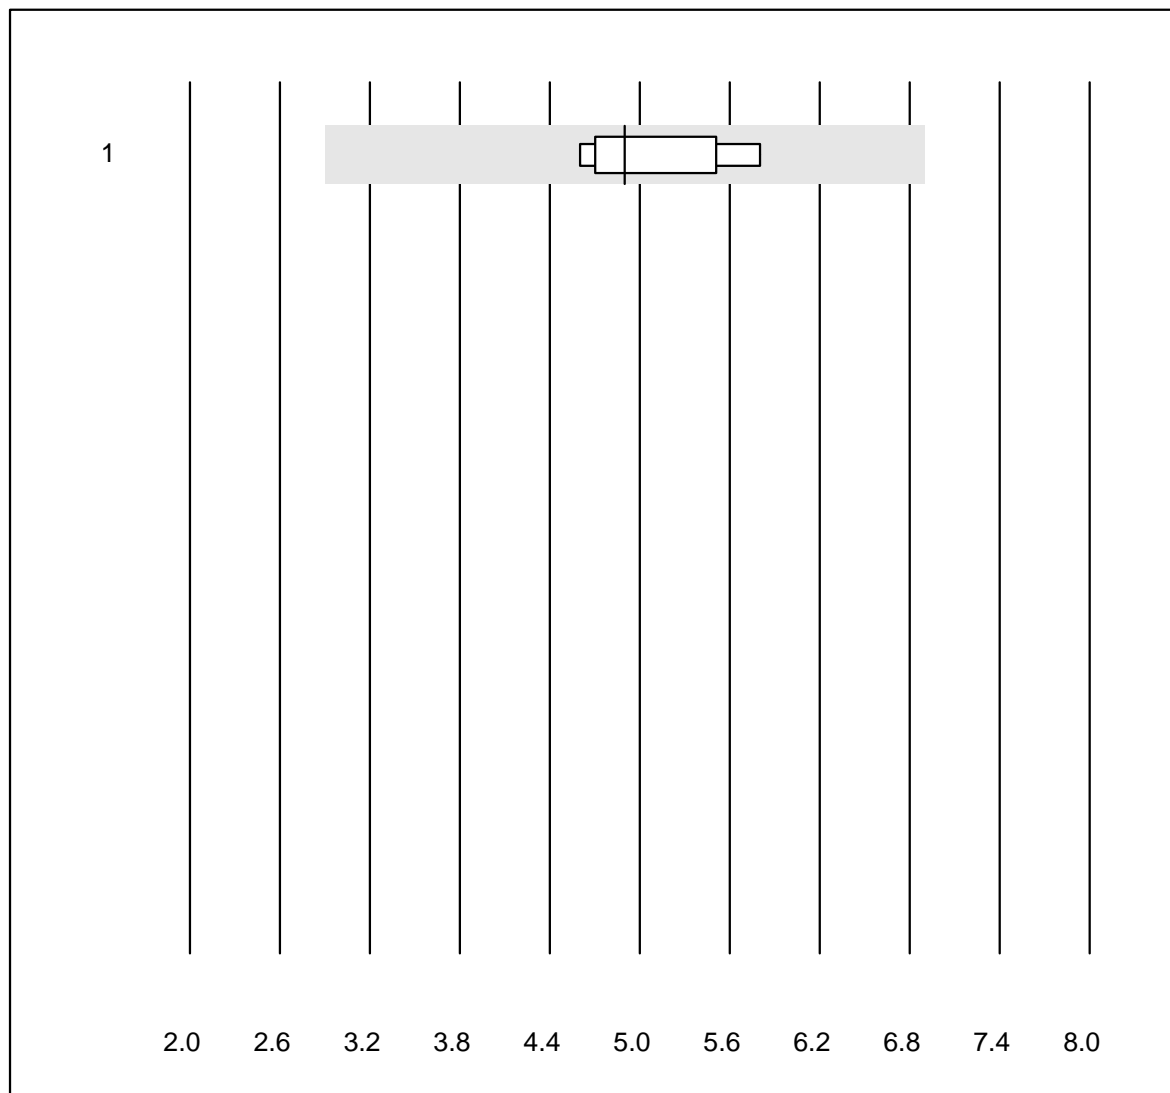


QUALAB Tolérance : 21 %  
( < 10.00: +/- 2.00 mg/l)

CRP HS (mg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Turbidimetrie	8	100.0	0.0	0.0	4.90	8.8	e*

## Lipoprotein (a)

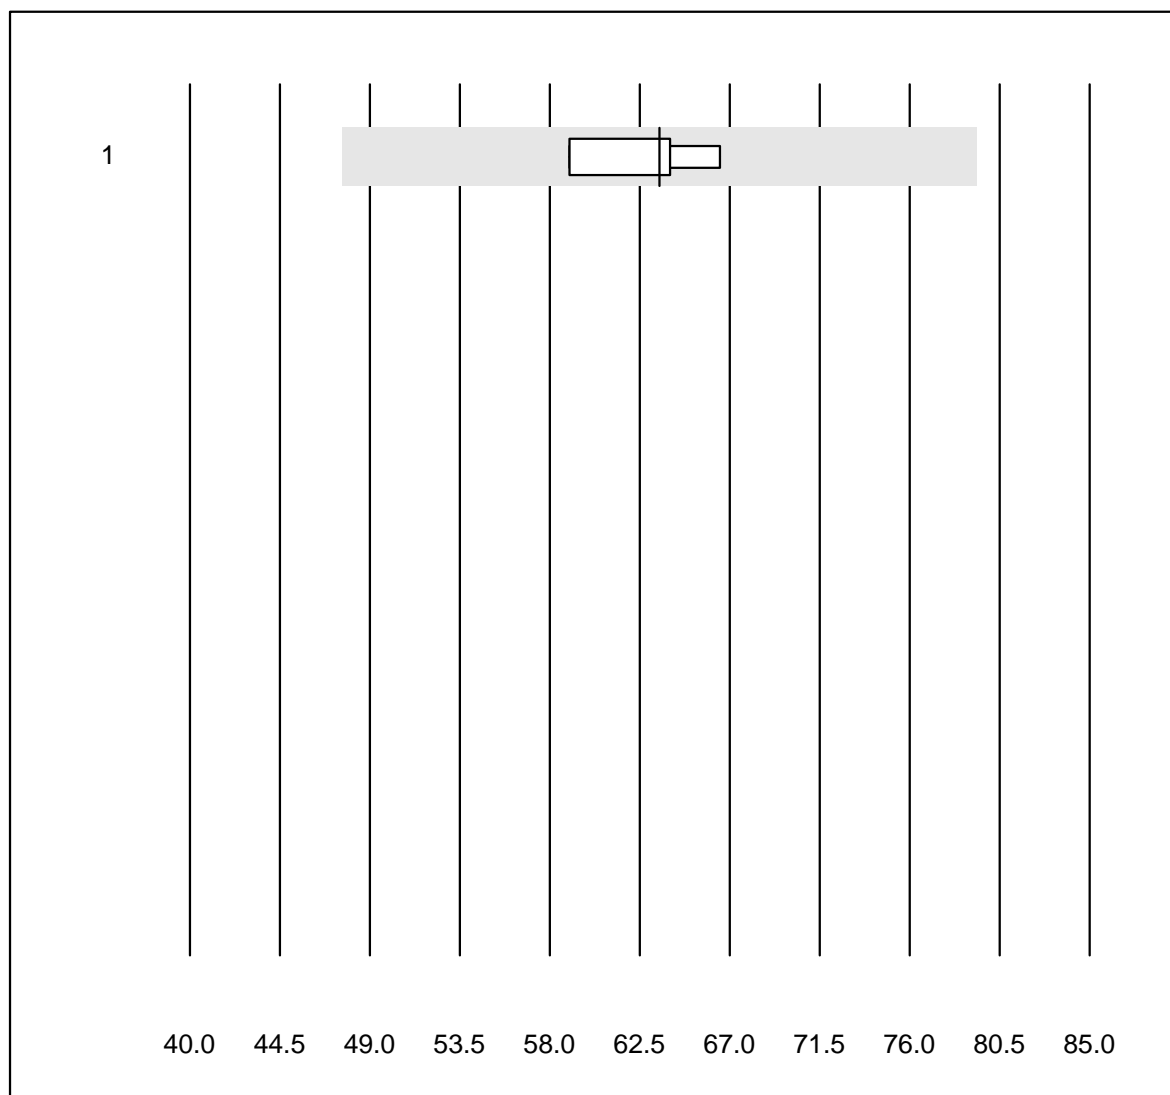


Tolérance MQ : 25 %

Lipoprotein (a) (nmol/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	64	5.0	e

# CRP

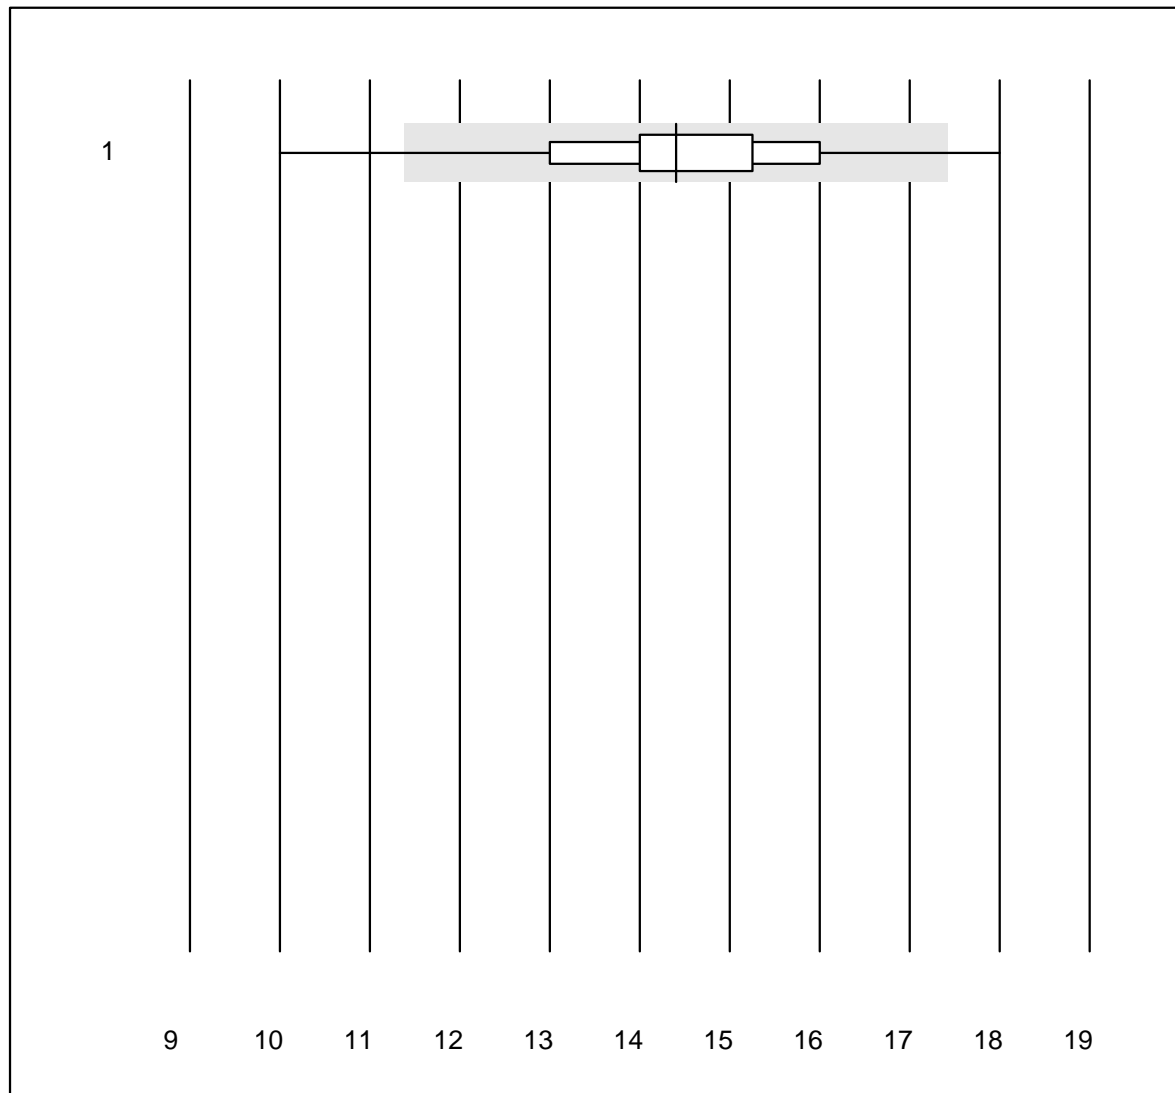


QUALAB Tolérance : 21 %

CRP (mg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 AFIAS	131	93.8	3.1	3.1	14.4	8.9	e

## Anti tTG IgA

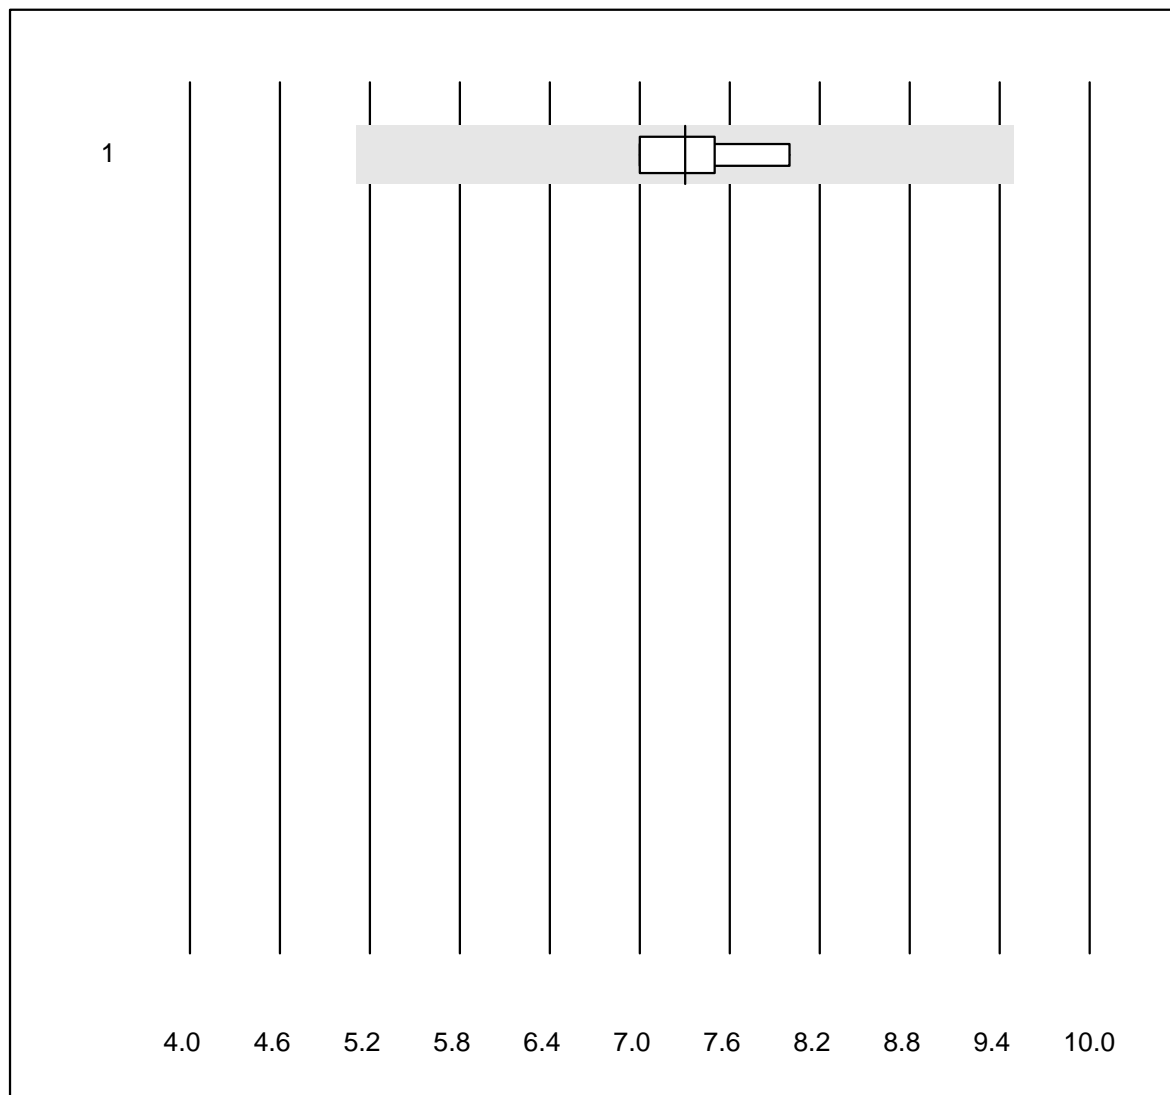


Tolérance MQ : 30 %

Anti tTG IgA (U/ml)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Autres méthodes	5	100.0	0.0	0.0	7.30	5.7	e

# Albumine

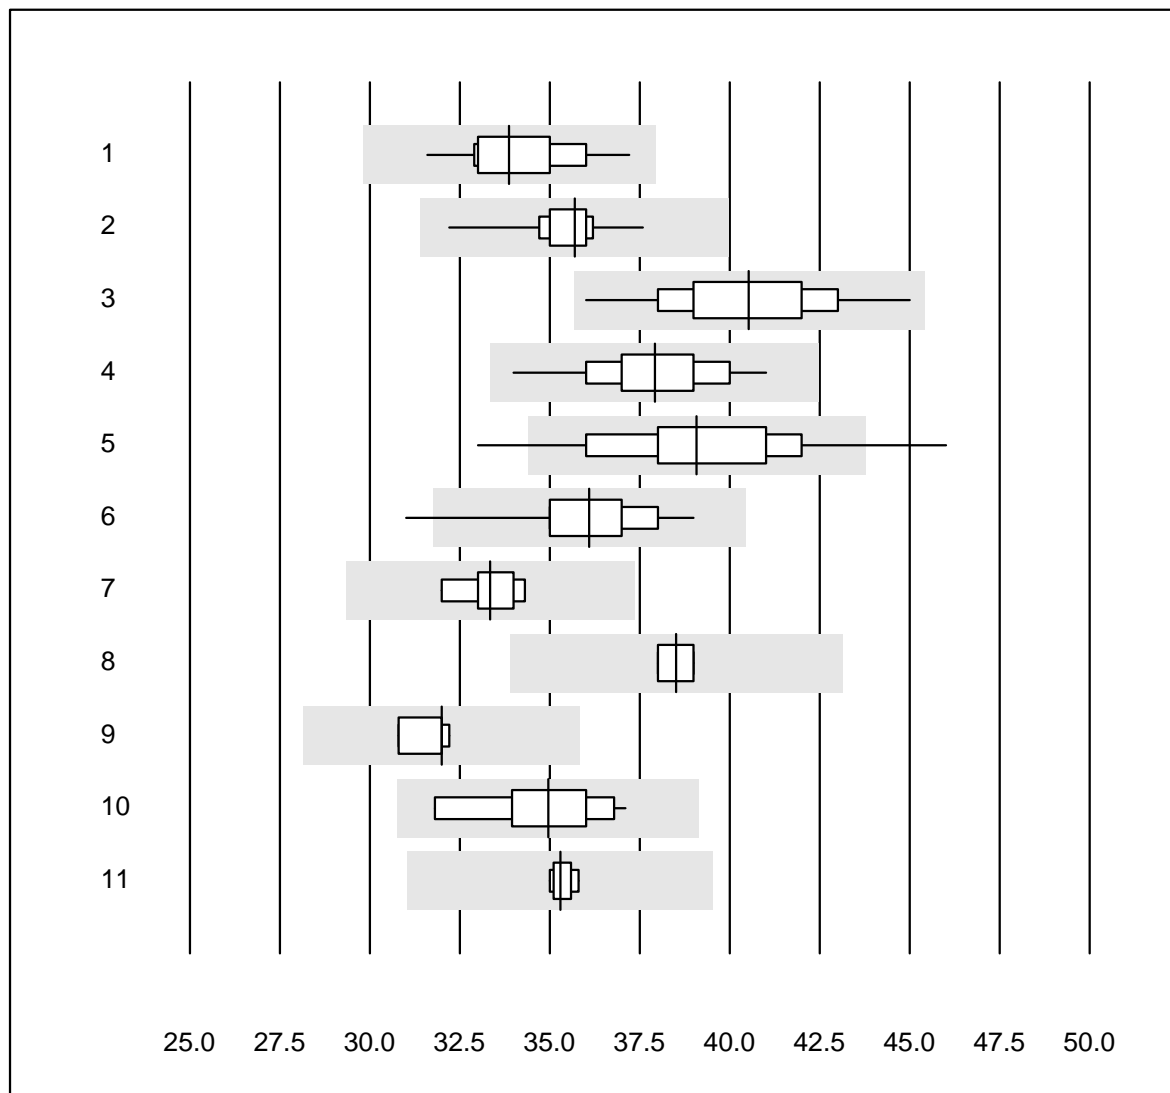


QUALAB Tolérance : 12 %

Albumine (g/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	16	100.0	0.0	0.0	34	4.2	e
2 Cobas	21	100.0	0.0	0.0	36	3.2	e
3 Fuji Dri-Chem	241	98.8	0.0	1.2	41	4.2	e
4 Spotchem SP-4430	25	100.0	0.0	0.0	38	4.8	e
5 Spotchem D-Concept	174	93.7	5.2	1.1	39	6.1	e
6 Piccolo	61	98.4	1.6	0.0	36	4.0	e
7 Beckmann	6	100.0	0.0	0.0	33	2.5	e
8 Skyla	4	100.0	0.0	0.0	39	1.5	e
9 Dimension	4	100.0	0.0	0.0	32	2.0	e
10 Selectra Pro	10	100.0	0.0	0.0	35	4.9	e*
11 Autolyser/DiaSys	8	100.0	0.0	0.0	35	0.9	e

## Phosphatase alcaline

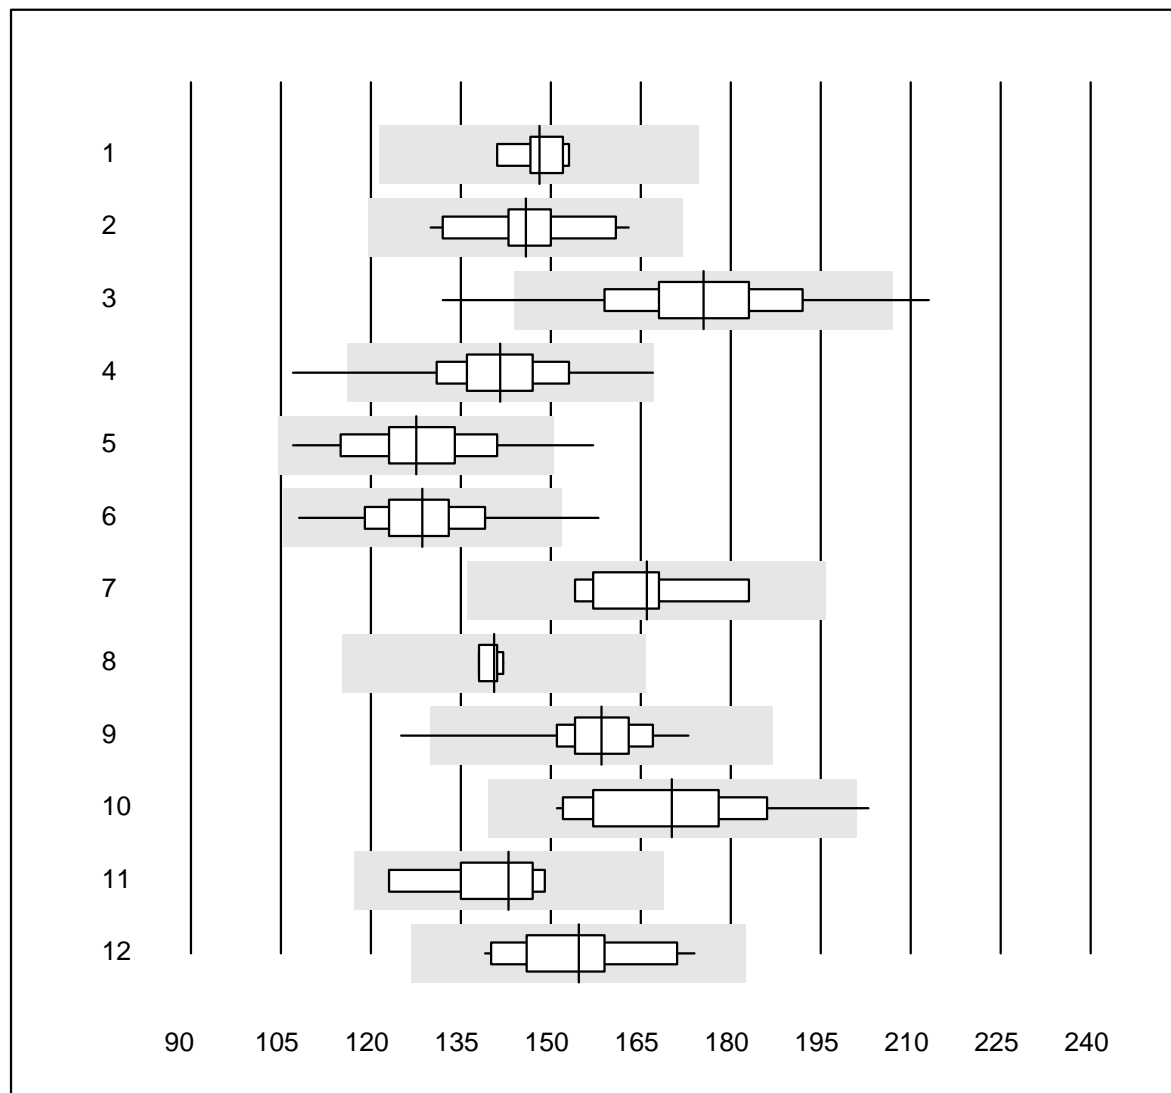


QUALAB Tolérance : 18 %

Phosphatase alcaline (U/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 IFCC	9	100.0	0.0	0.0	148	3.0	e
2 Cobas	22	100.0	0.0	0.0	146	6.1	e
3 Reflotron	365	96.7	1.9	1.4	175	7.3	e
4 Fuji Dri-Chem	888	99.7	0.1	0.2	142	5.9	e
5 Spotchem SP-4430	50	98.0	2.0	0.0	128	8.0	e
6 Spotchem D-Concept	350	98.8	0.3	0.9	129	5.9	e
7 Beckman	8	100.0	0.0	0.0	166	5.8	e
8 Dimension	4	100.0	0.0	0.0	141	1.2	e
9 Piccolo	52	94.3	1.9	3.8	158	5.0	e
10 Selectra Pro	15	93.3	6.7	0.0	170	8.3	e
11 Skyla	6	100.0	0.0	0.0	143	7.1	e*
12 Autolyser/DiaSys	20	100.0	0.0	0.0	155	6.8	e
13 Autres méthodes	5	100.0	0.0	0.0	149	4.2	e



## Amylase

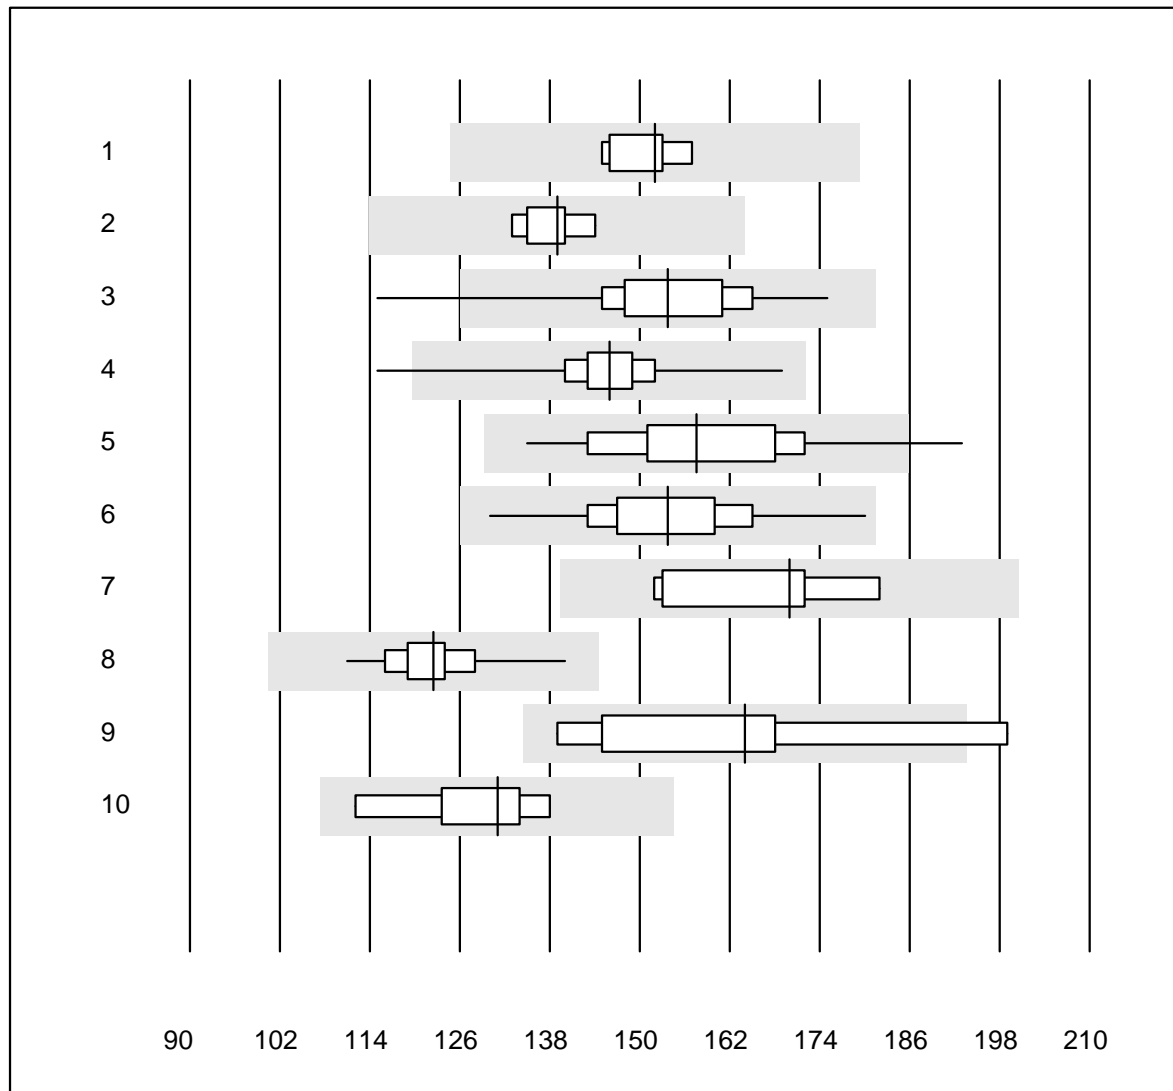


QUALAB Tolérance : 18 %

Amylase (U/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 IFCC	7	100.0	0.0	0.0	152	2.8	e
2 Cobas	8	100.0	0.0	0.0	139	2.6	e
3 Reflotron	96	95.8	2.1	2.1	154	6.2	e
4 Fuji Dri-Chem	647	99.4	0.3	0.3	146	3.7	e
5 Spotchem SP-4430	42	97.6	2.4	0.0	158	7.8	e
6 Spotchem D-Concept	270	98.9	0.0	1.1	154	5.8	e
7 Architect	5	100.0	0.0	0.0	170	7.8	e*
8 Piccolo	53	100.0	0.0	0.0	122	4.1	e
9 Selectra Pro	7	85.7	14.3	0.0	164	12.0	e*
10 Autolyser/DiaSys	7	100.0	0.0	0.0	131	6.7	e*

## Amylase pancréatique

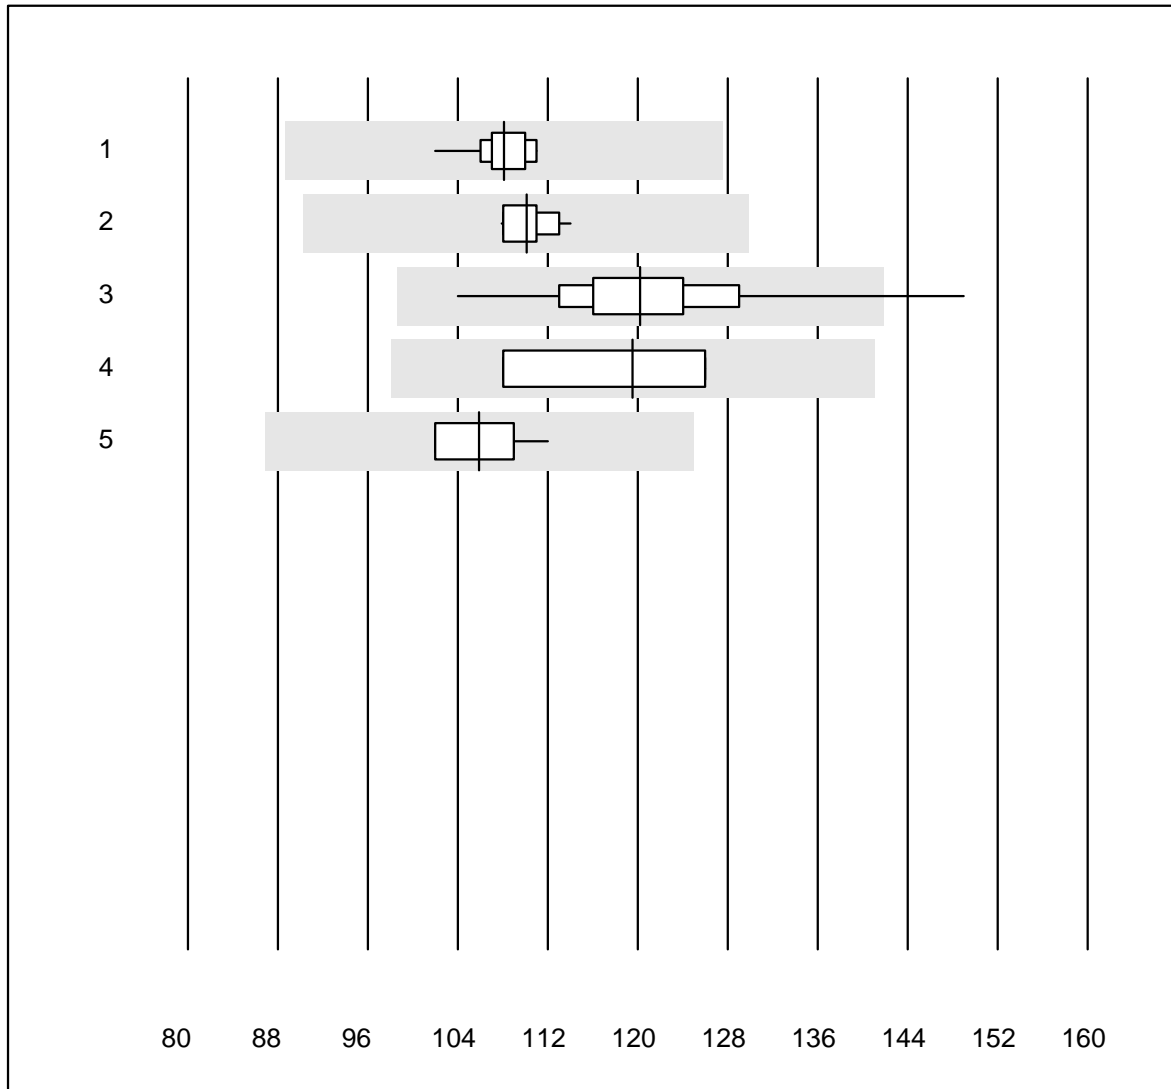


QUALAB Tolérance : 18 %

Amylase pancréatique (U/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 IFCC	11	100.0	0.0	0.0	108	2.4	e
2 Cobas	11	100.0	0.0	0.0	110	1.8	e
3 Reflotron	263	96.6	1.1	2.3	120	5.6	e
4 humide autres 37°C	4	75.0	0.0	25.0	120	8.0	e*
5 Autolyser/DiaSys	11	100.0	0.0	0.0	106	3.1	e

## Bilirubine totale

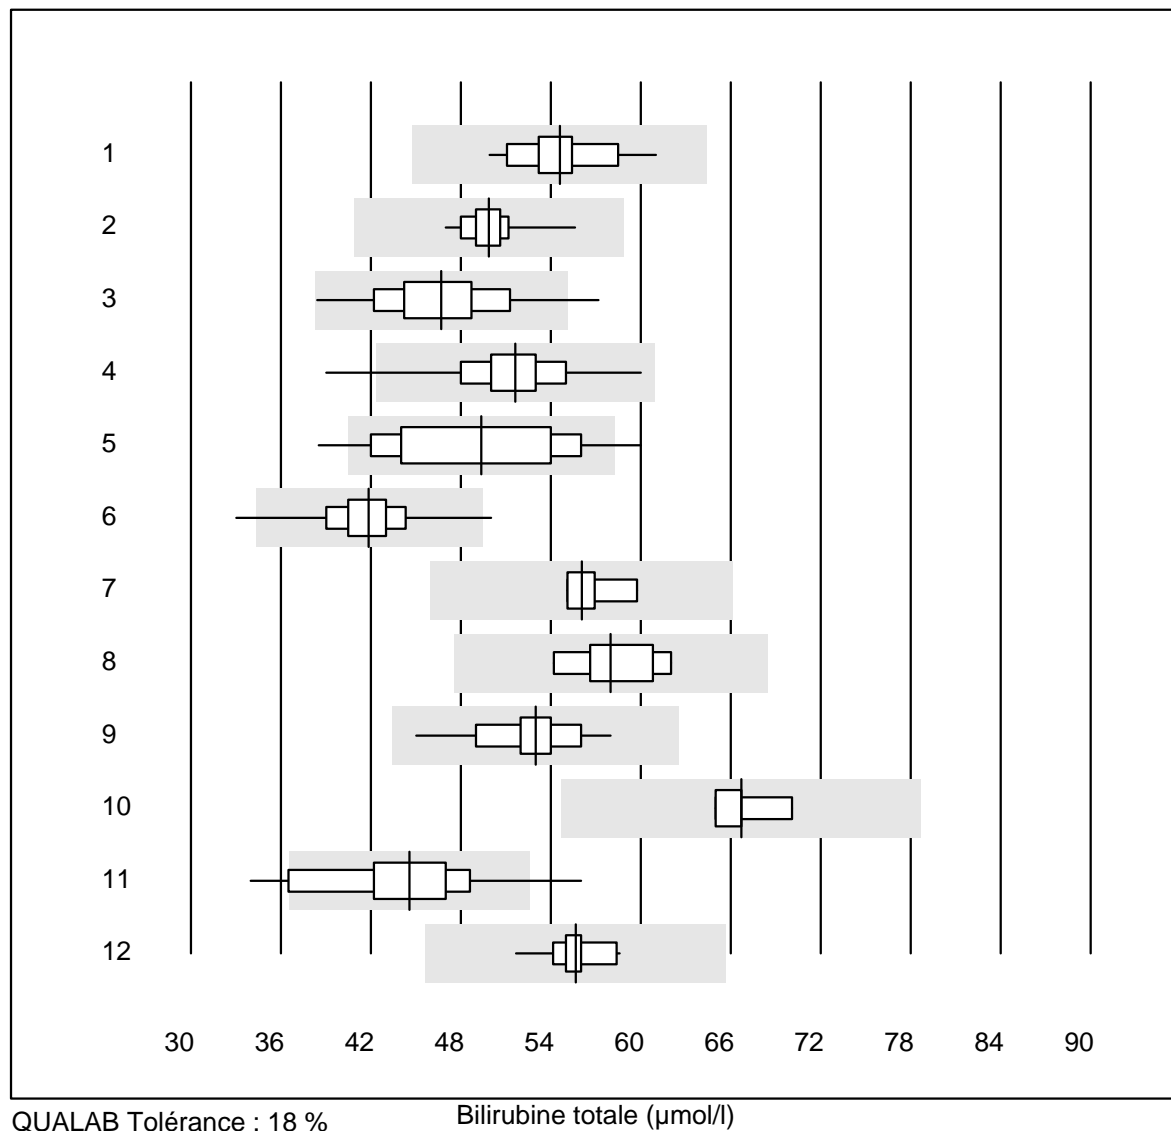

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	Chimie humide	17	94.1	0.0	5.9	54.6	5.0	e
2	Cobas	21	100.0	0.0	0.0	49.9	3.7	e
3	Reflotron	289	96.2	1.4	2.4	46.7	7.4	e
4	Fuji Dri-Chem	713	99.0	0.6	0.4	51.6	5.2	e
5	Spotchem SP-4430	51	84.3	15.7	0.0	49.4	11.6	e
6	Spotchem D-Concept	281	97.9	1.4	0.7	41.9	5.4	e
7	Dimension	4	100.0	0.0	0.0	56.1	3.8	e
8	Beckman	7	100.0	0.0	0.0	58.0	4.5	e
9	Piccolo	60	100.0	0.0	0.0	53.0	4.9	e
10	Skylla	4	100.0	0.0	0.0	66.7	3.2	e
11	Selectra Pro	16	68.7	18.8	12.5	44.6	12.0	e*
12	Autolyser/DiaSys	17	100.0	0.0	0.0	55.7	2.9	e

## Bilirubine directe

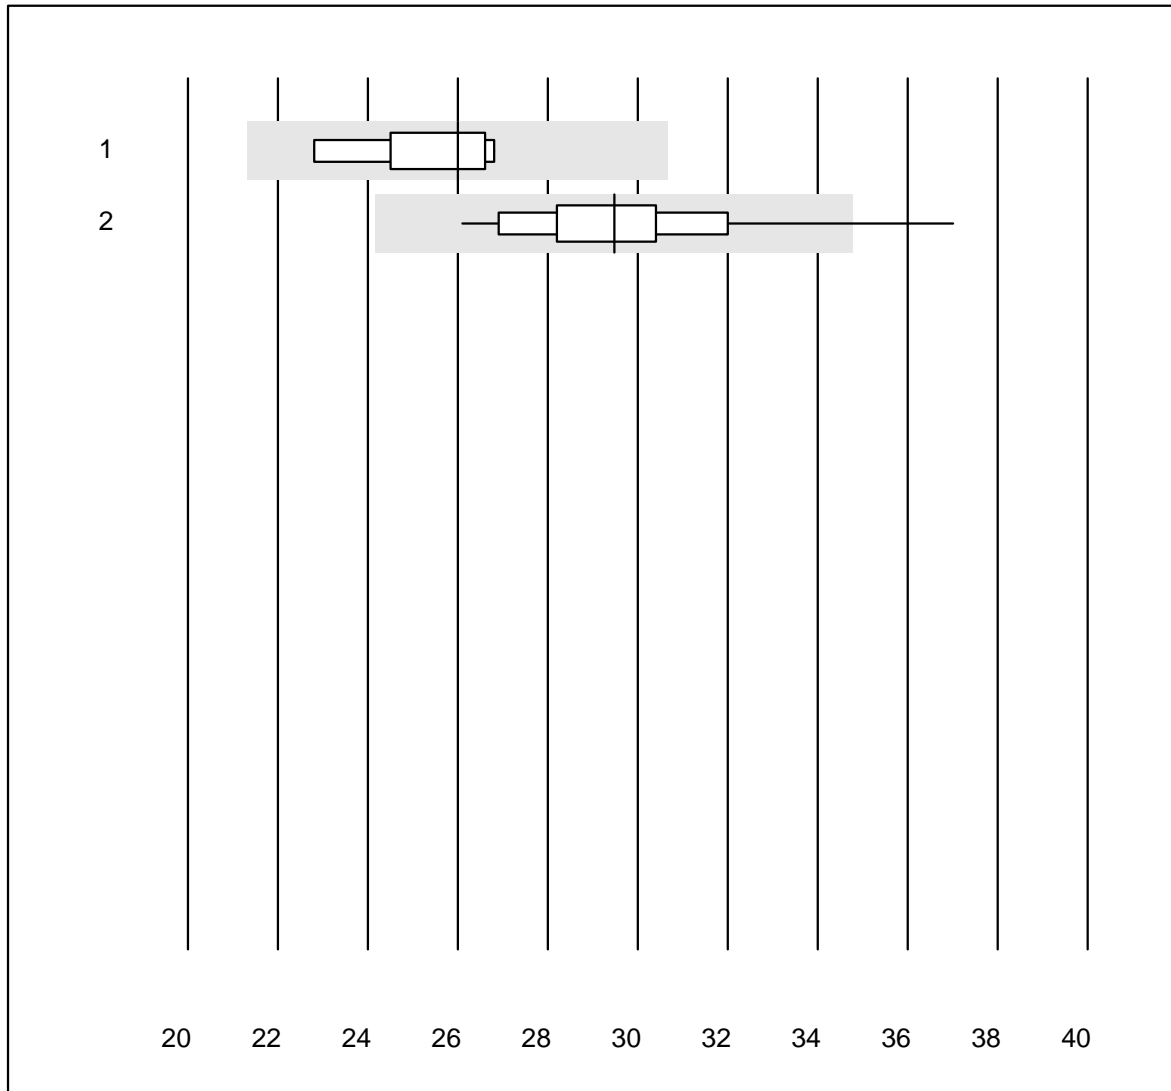


Tolérance MQ : 18 %

Bilirubine directe (µmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Autolyser/DiaSys	7	100.0	0.0	0.0	26.0	5.6	e
2 Fuji Dri-Chem	29	96.6	3.4	0.0	29.5	7.2	e

# Calcium

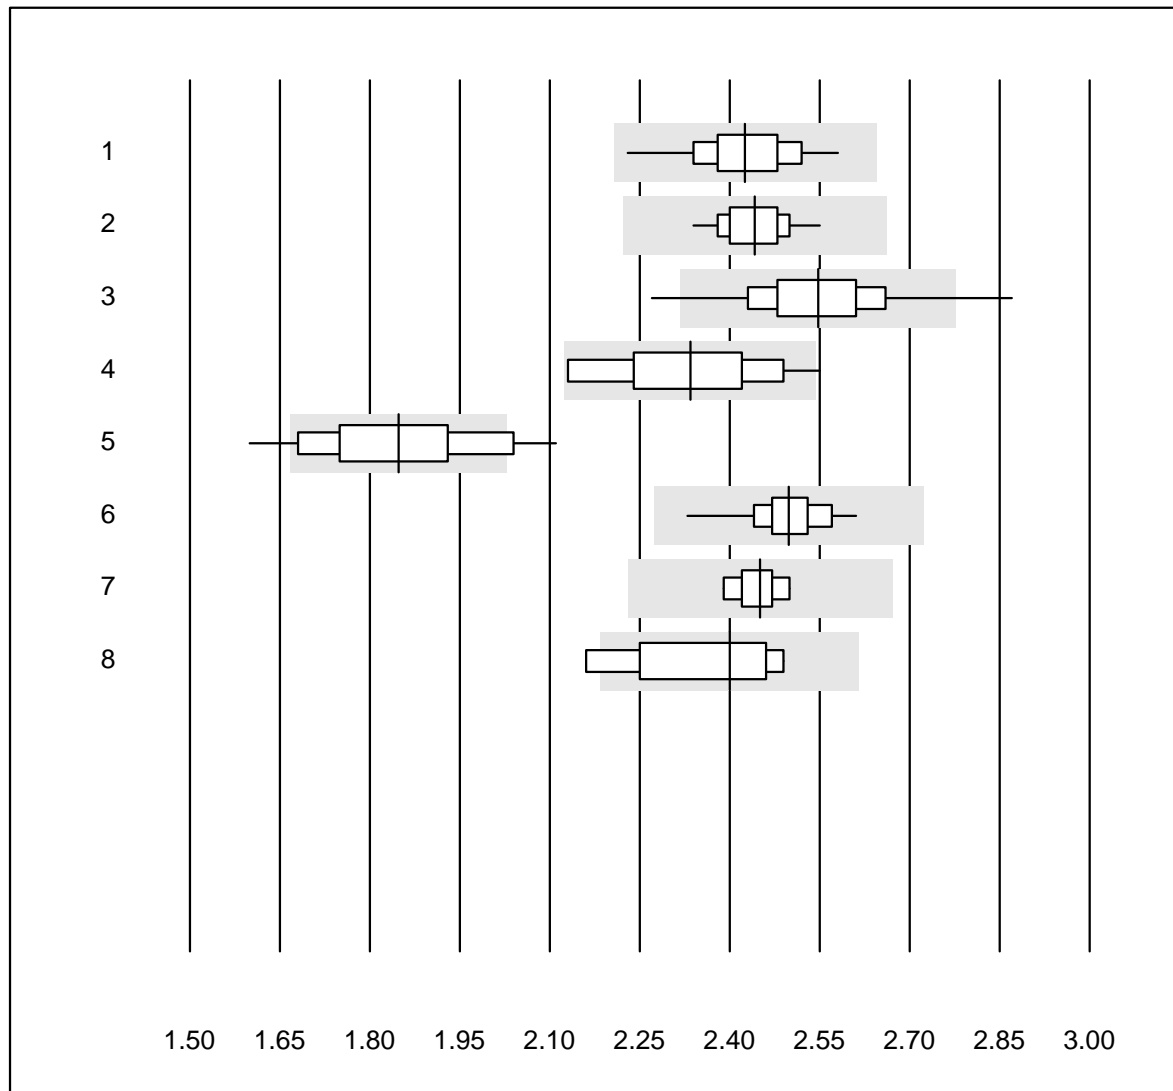


QUALAB Tolérance : 9 %  
( < 2.00: +/- 0.18 mmol/l)

Calcium (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	Chimie humide	26	100.0	0.0	0.0	2.43	3.1	e
2	Cobas	21	100.0	0.0	0.0	2.44	2.2	e
3	Fuji Dri-Chem	340	97.0	1.8	1.2	2.55	3.7	e
4	Spotchem SP-4430	12	75.0	8.3	16.7	2.33	5.6	e*
5	Spotchem D-Concept	78	77.0	17.9	5.1	1.85	6.9	e
6	Piccolo	54	100.0	0.0	0.0	2.50	2.2	e
7	Selectra Pro	6	100.0	0.0	0.0	2.45	1.6	e
8	Autolyser/DiaSys	9	88.9	11.1	0.0	2.40	5.1	e*

## Calcium ISE

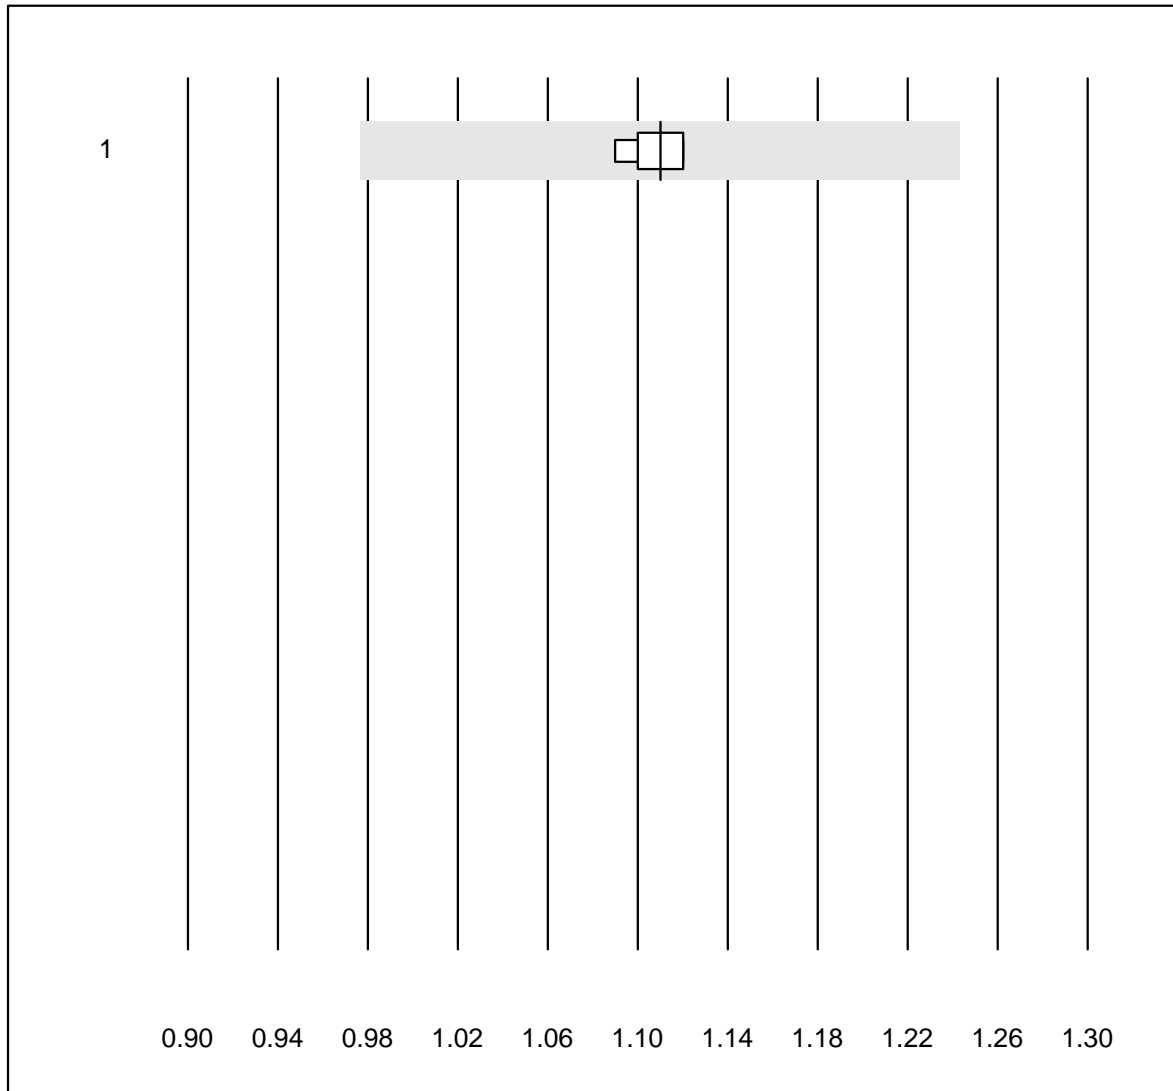


Tolérance MQ : 12 %

Calcium ISE (mmol/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 iStat Chem8	5	100.0	0.0	0.0	1.11	1.2	e

## Chlorures

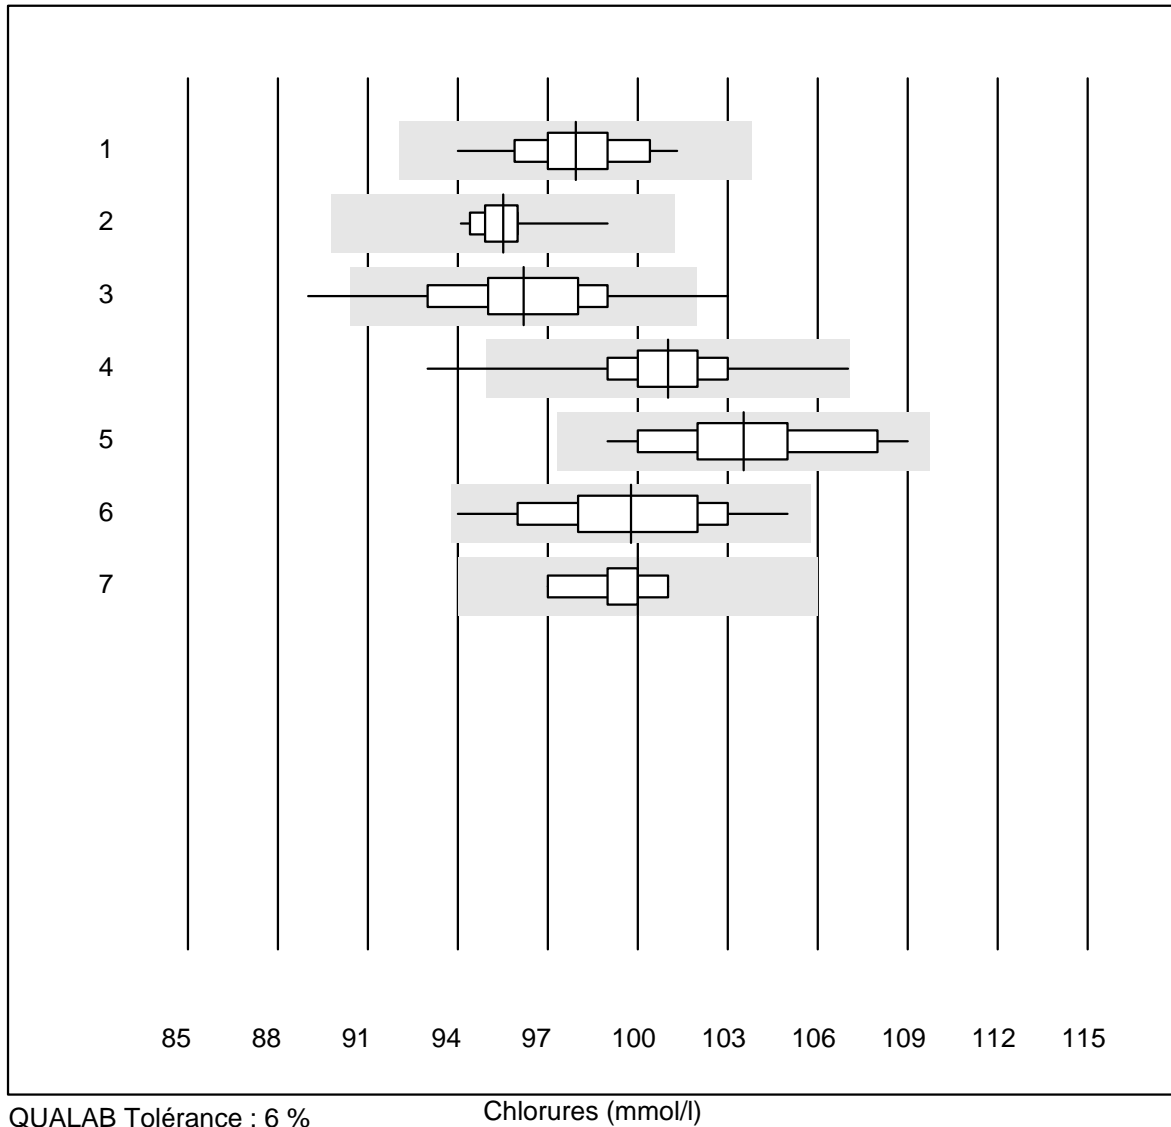

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 ISE	27	96.3	0.0	3.7	98	1.9	e
2 Cobas	12	100.0	0.0	0.0	96	1.3	e
3 Fuji Dri-Chem	808	96.8	2.1	1.1	96	2.3	e
4 Spotchem D-Concept	319	97.2	0.6	2.2	101	1.9	e
5 Spotchem EL-SE 1520	57	94.7	0.0	5.3	104	2.7	e
6 Piccolo	26	100.0	0.0	0.0	100	2.6	e
7 iStat Chem8	5	100.0	0.0	0.0	100	1.5	e

## Cholestérol

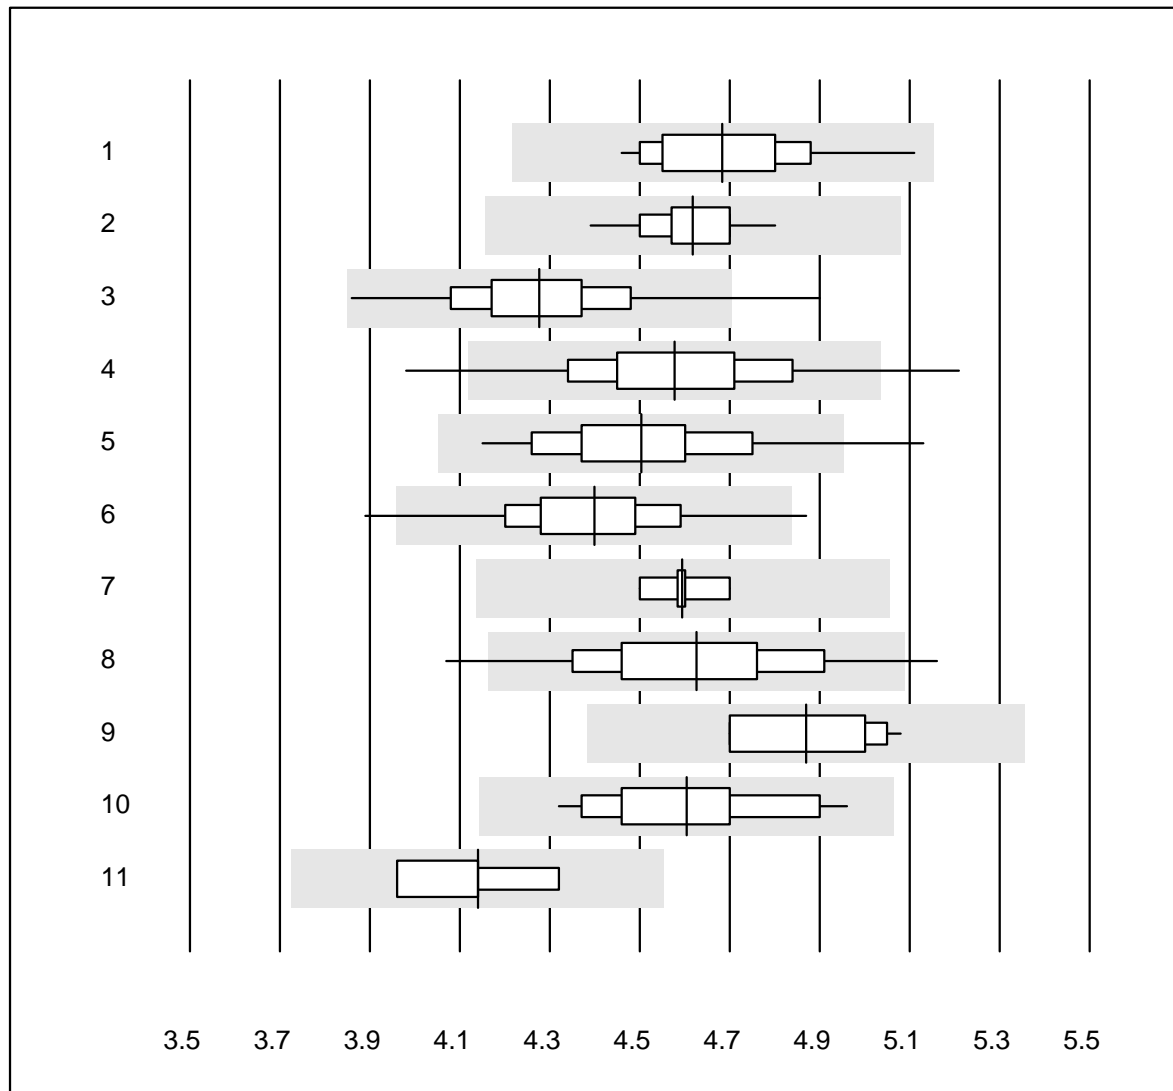


QUALAB Tolérance : 10 %

Cholestérol (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	25	100.0	0.0	0.0	4.68	3.5	e
2 Cobas	21	100.0	0.0	0.0	4.62	2.3	e
3 Reflotron	281	97.2	0.7	2.1	4.28	3.8	e
4 Fuji Dri-Chem	854	96.4	2.7	0.9	4.58	4.3	e
5 Spotchem SP-4430	70	98.6	1.4	0.0	4.50	4.2	e
6 Spotchem D-Concept	348	97.4	0.6	2.0	4.40	3.5	e
7 Piccolo	24	100.0	0.0	0.0	4.59	1.3	e
8 Cholestech LDX	308	93.5	4.2	2.3	4.63	4.7	e
9 Selectra Pro	14	78.6	0.0	21.4	4.87	3.0	e
10 Autolyser/DiaSys	20	95.0	0.0	5.0	4.60	3.7	e
11 Autres méthodes	5	80.0	0.0	20.0	4.14	3.7	e*



## Cholestérol HDL

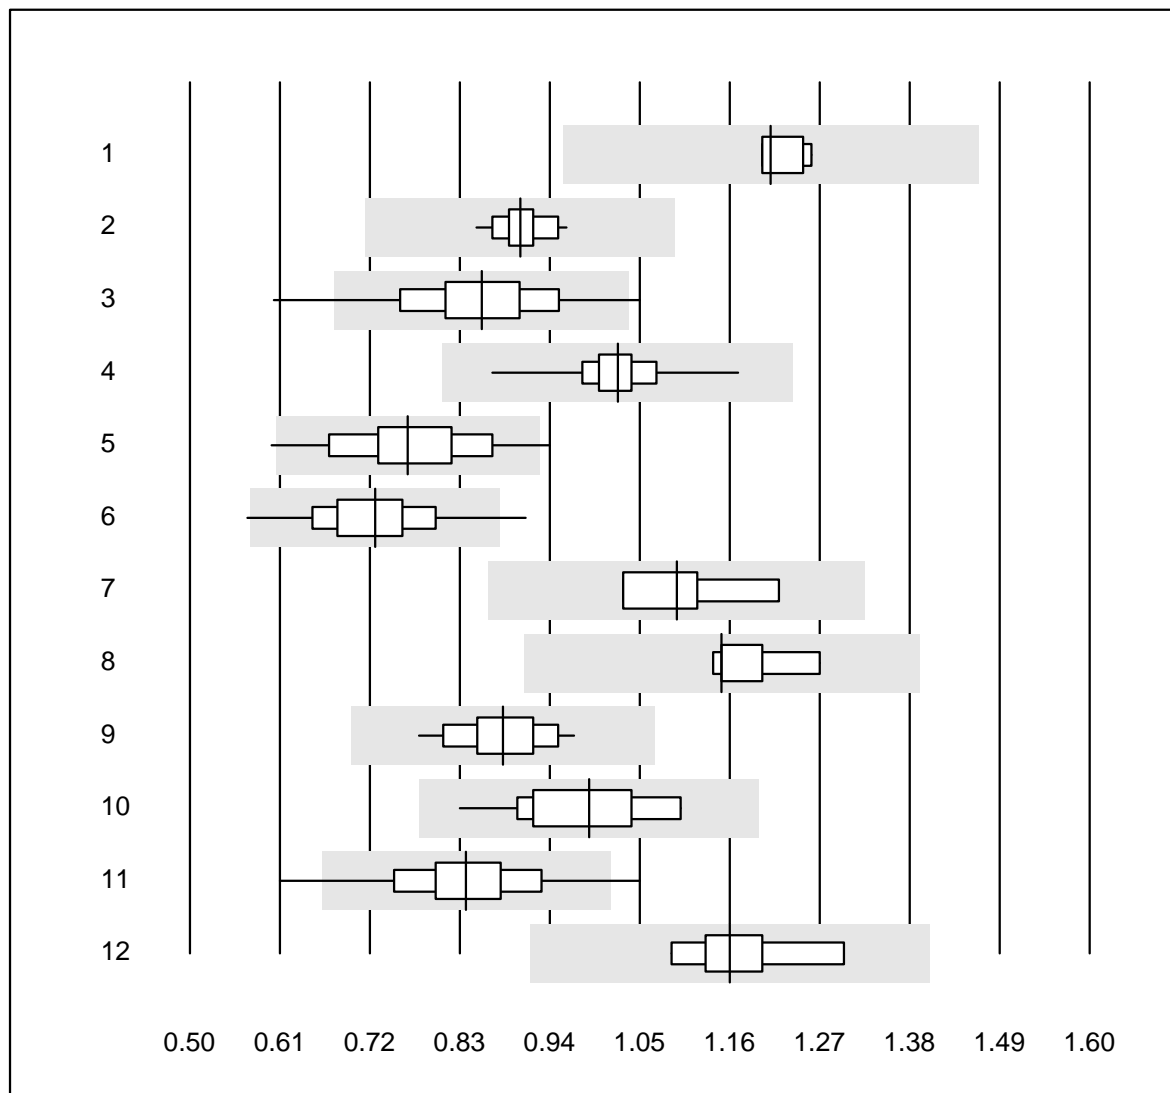


QUALAB Tolérance : 21 %

Cholestérol HDL (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	humide, direct	7	100.0	0.0	0.0	1.21	2.1	e
2	Cobas	19	100.0	0.0	0.0	0.90	3.2	e
3	Reflotron	192	92.2	3.1	4.7	0.86	9.1	e
4	Fuji Dri-Chem	831	98.7	0.0	1.3	1.02	3.4	e
5	Spotchem SP-4430	63	92.0	4.8	3.2	0.77	9.4	e
6	Spotchem D-Concept	343	96.3	1.7	2.0	0.73	8.2	e
7	Dimension	4	100.0	0.0	0.0	1.10	7.4	e*
8	humide, precipitatio	5	100.0	0.0	0.0	1.15	4.6	e
9	Piccolo	22	100.0	0.0	0.0	0.88	5.8	e
10	Pentra/Selectra	13	100.0	0.0	0.0	0.99	8.4	e
11	Cholestech LDX	307	93.8	3.3	2.9	0.84	8.8	e
12	Architect	9	100.0	0.0	0.0	1.16	5.1	e
13	Autolyser/DiaSys	20	100.0	0.0	0.0	1.11	5.8	e

## Créatine-kinase

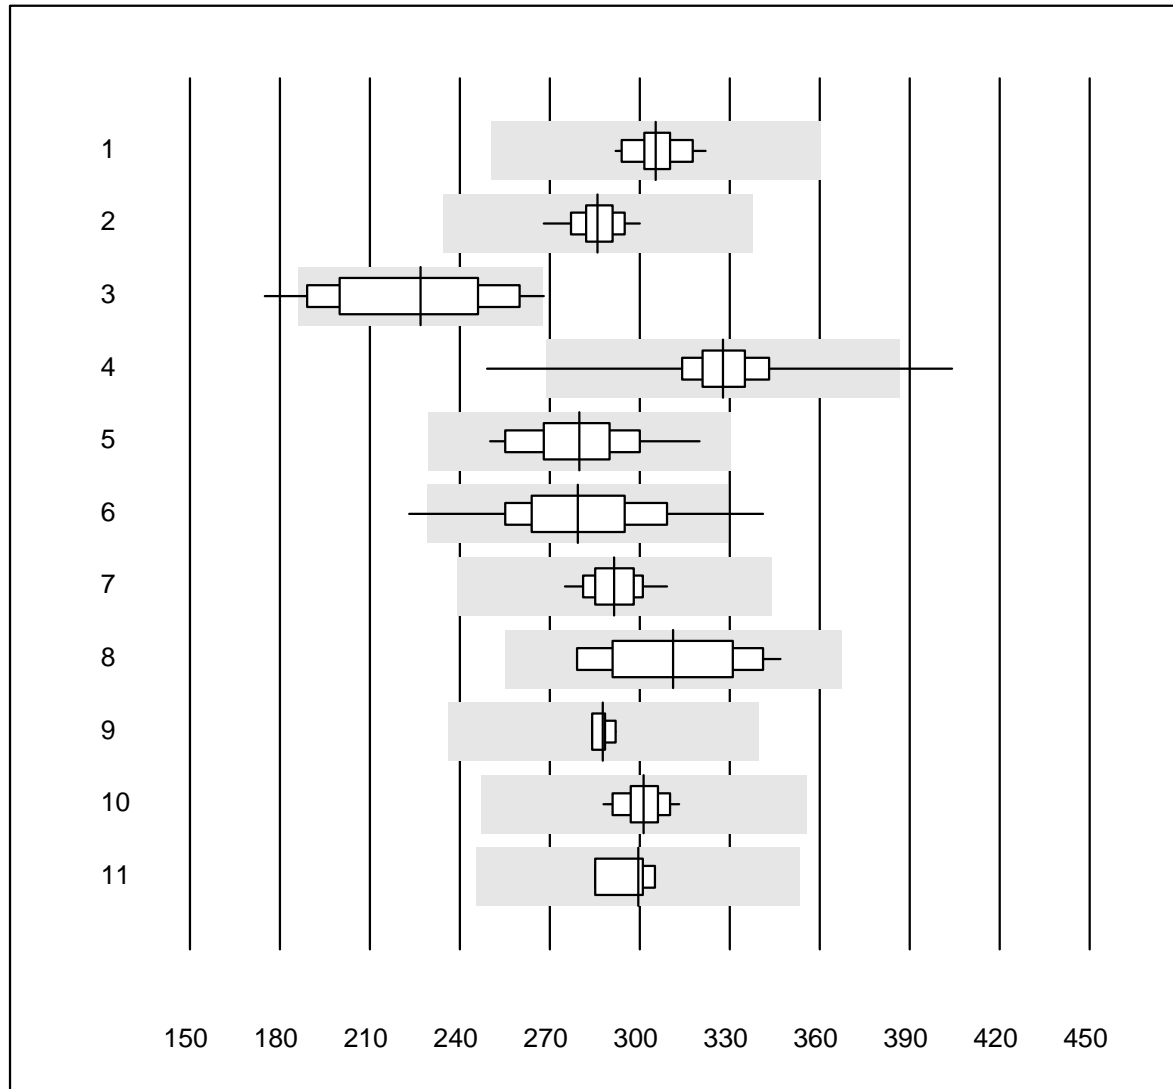


QUALAB Tolérance : 18 %

Créatine-kinase (U/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 IFCC	19	100.0	0.0	0.0	305	2.3	e
2 Cobas	19	100.0	0.0	0.0	286	2.5	e
3 Reflotron	30	83.3	6.7	10.0	227	11.3	e
4 Fuji Dri-Chem	595	98.4	0.8	0.8	328	4.2	e
5 Spotchem SP-4430	30	100.0	0.0	0.0	280	6.3	e
6 Spotchem D-Concept	213	97.2	2.3	0.5	279	7.6	e
7 Piccolo	23	100.0	0.0	0.0	291	2.8	e
8 Selectra Pro	11	90.9	0.0	9.1	311	7.7	e*
9 Dimension	4	100.0	0.0	0.0	288	1.2	e
10 Autolyser/DiaSys	16	100.0	0.0	0.0	301	2.3	e
11 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	300	2.9	e

## Cholestérol LDL

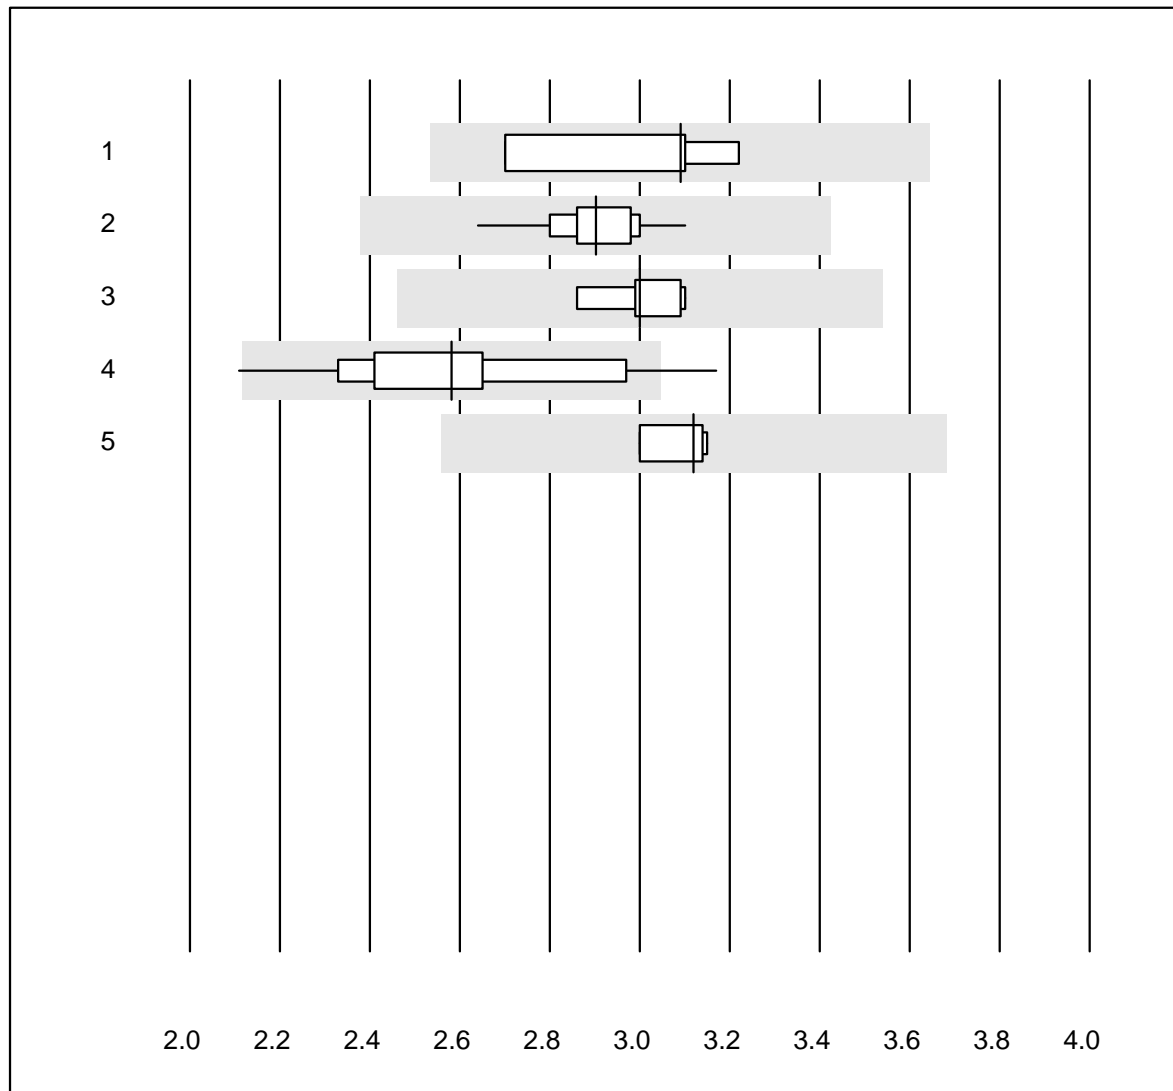


QUALAB Tolérance : 18 %

Cholestérol LDL (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Selectra	4	100.0	0.0	0.0	3.1	7.4	e*
2 Chimie humide	15	100.0	0.0	0.0	2.9	3.7	e
3 Roche, Cobas	10	100.0	0.0	0.0	3.0	2.8	e
4 Autolyser/DiaSys	13	84.6	15.4	0.0	2.6	11.1	e*
5 Beckman	4	100.0	0.0	0.0	3.1	2.2	e

# Fer

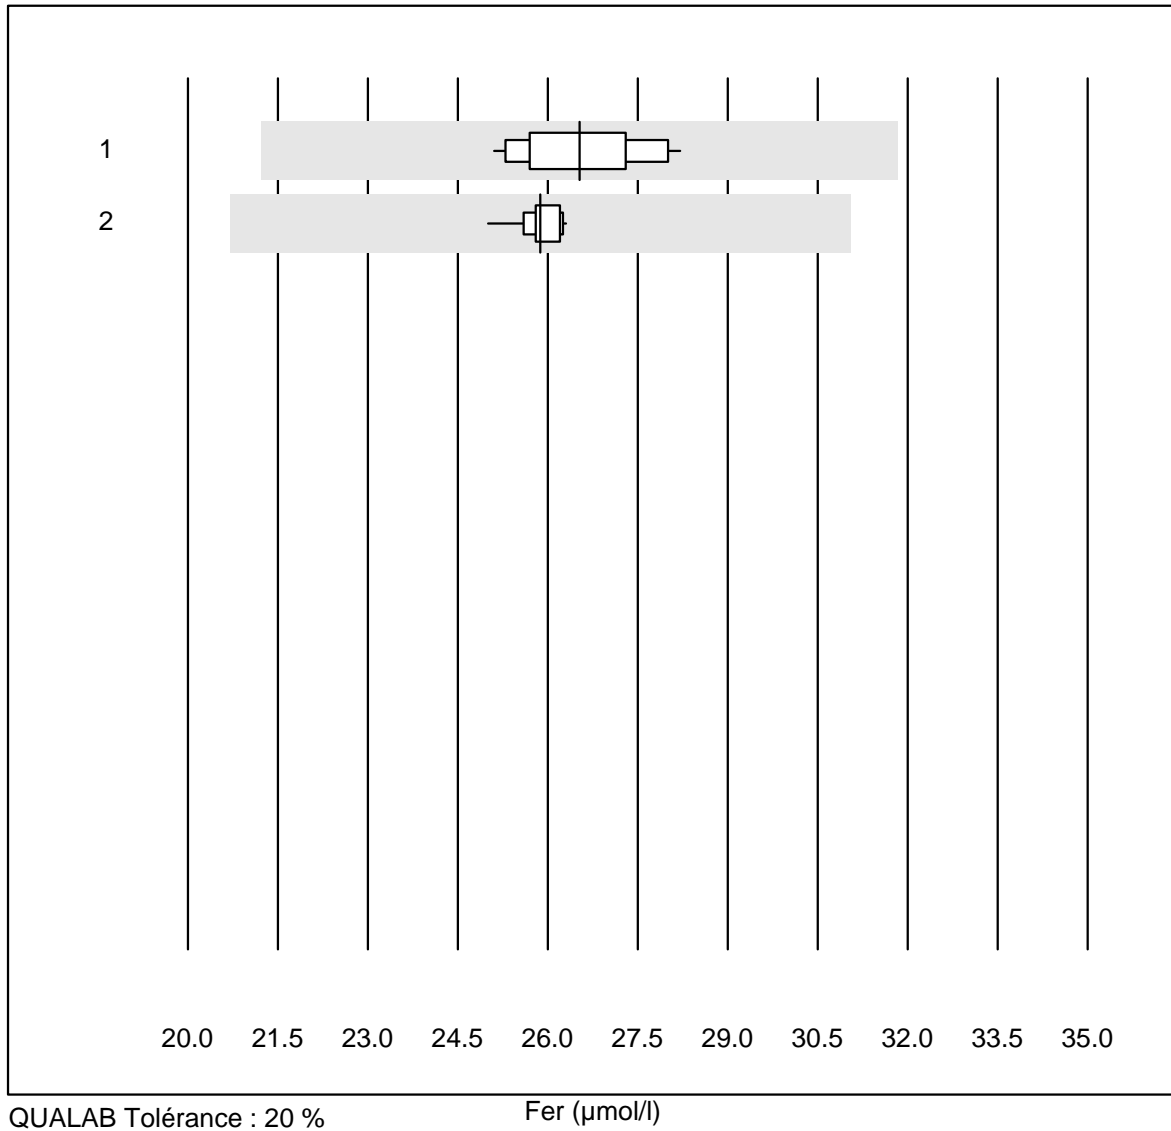


QUALAB Tolérance : 20 %

Fer ( $\mu\text{mol/l}$ )

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	15	100.0	0.0	0.0	27	3.9	e
2 Cobas	11	100.0	0.0	0.0	26	1.4	e

## Gamma-GT

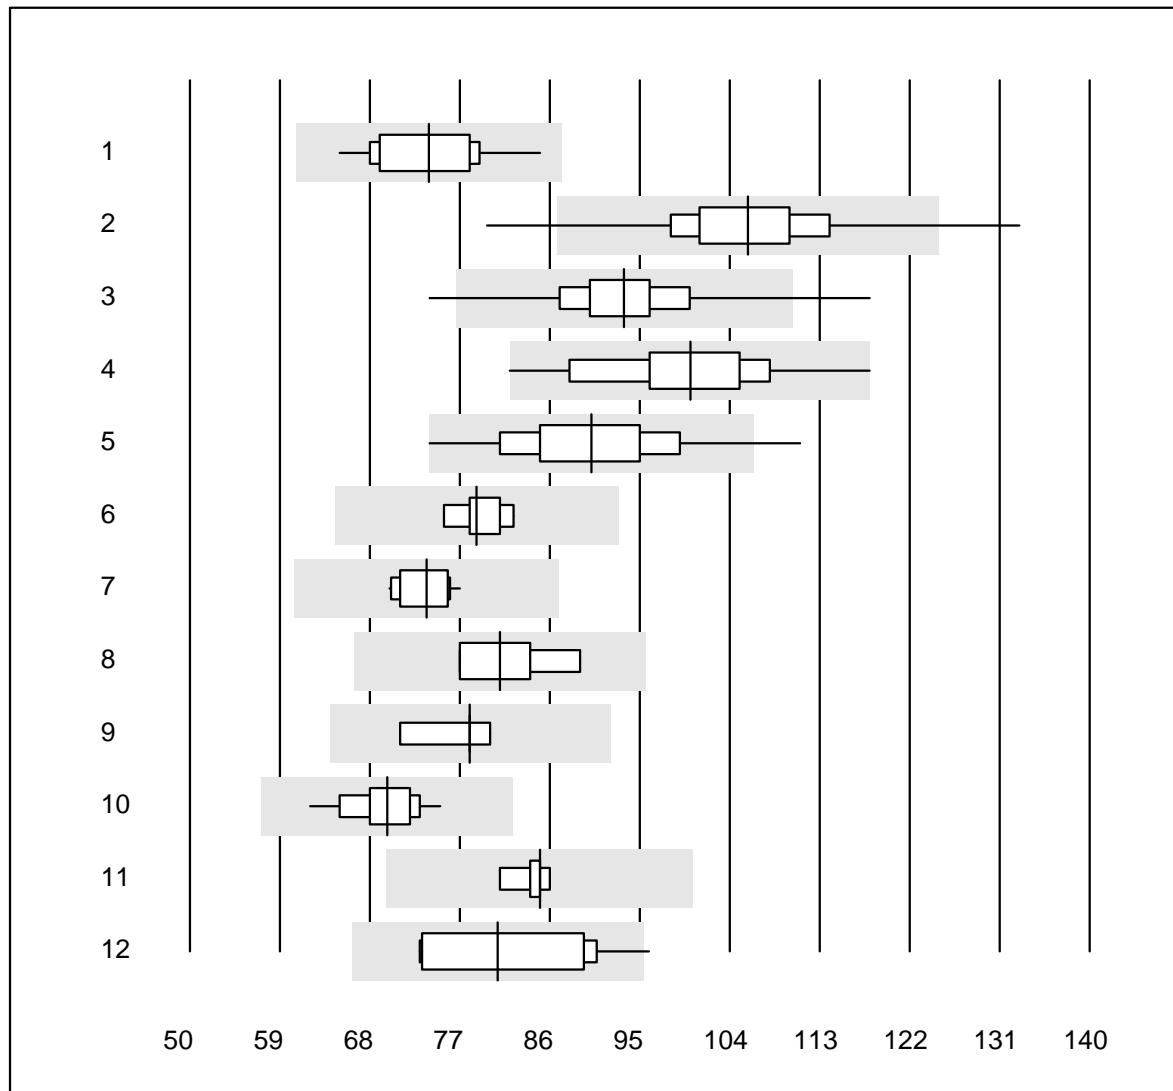


QUALAB Tolérance : 18 %

Gamma-GT (U/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	22	100.0	0.0	0.0	74	7.2	e
2 Reflotron	500	97.2	1.0	1.8	106	6.4	e
3 Fuji Dri-Chem	966	99.4	0.3	0.3	93	5.3	e
4 Spotchem SP-4430	80	97.5	2.5	0.0	100	7.6	e
5 Spotchem D-Concept	395	98.2	0.8	1.0	90	7.7	e
6 Selectra/Biolis	5	100.0	0.0	0.0	79	3.4	e
7 Architect	12	100.0	0.0	0.0	74	3.3	e
8 Dimension	5	100.0	0.0	0.0	81	6.2	e*
9 IFCC Beckmann	6	100.0	0.0	0.0	78	4.0	e
10 Piccolo	50	100.0	0.0	0.0	70	4.0	e
11 Skyla	5	100.0	0.0	0.0	85	2.3	e
12 Selectra Pro	10	90.0	10.0	0.0	81	10.2	e*
13 Autolyser/DiaSys	20	100.0	0.0	0.0	81	3.0	e

## Glucose

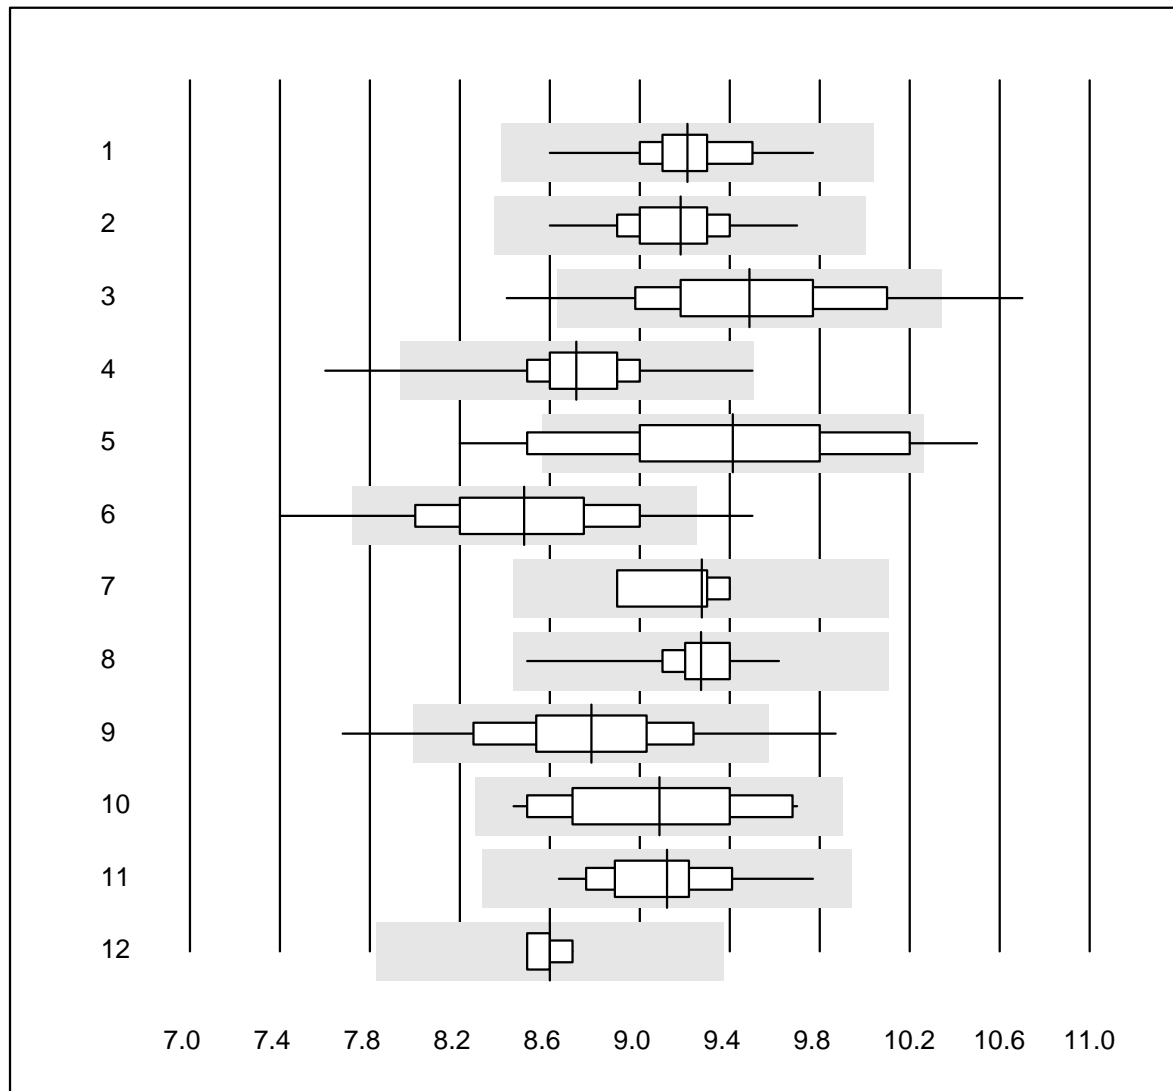


QUALAB Tolérance : 9 %

Glucose (mmol/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	27	96.3	0.0	3.7	9.2	2.6	e
2 Cobas	21	100.0	0.0	0.0	9.2	2.6	e
3 Reflotron	493	90.0	6.3	3.7	9.5	4.7	e
4 Fuji Dri-Chem	917	99.7	0.2	0.1	8.7	2.6	e
5 Spotchem SP-4430	69	81.2	14.5	4.3	9.4	6.1	e
6 Spotchem D-Concept	367	91.6	6.8	1.6	8.5	4.6	e
7 Dimension	4	100.0	0.0	0.0	9.3	2.4	e*
8 Piccolo	65	100.0	0.0	0.0	9.3	1.8	e
9 Cholestech LDX	303	94.4	4.6	1.0	8.8	4.5	e
10 Selectra Pro	15	100.0	0.0	0.0	9.1	4.4	e*
11 Autolyser/DiaSys	20	100.0	0.0	0.0	9.1	3.2	e
12 iStat Chem8	7	100.0	0.0	0.0	8.6	0.8	e

## Glucose

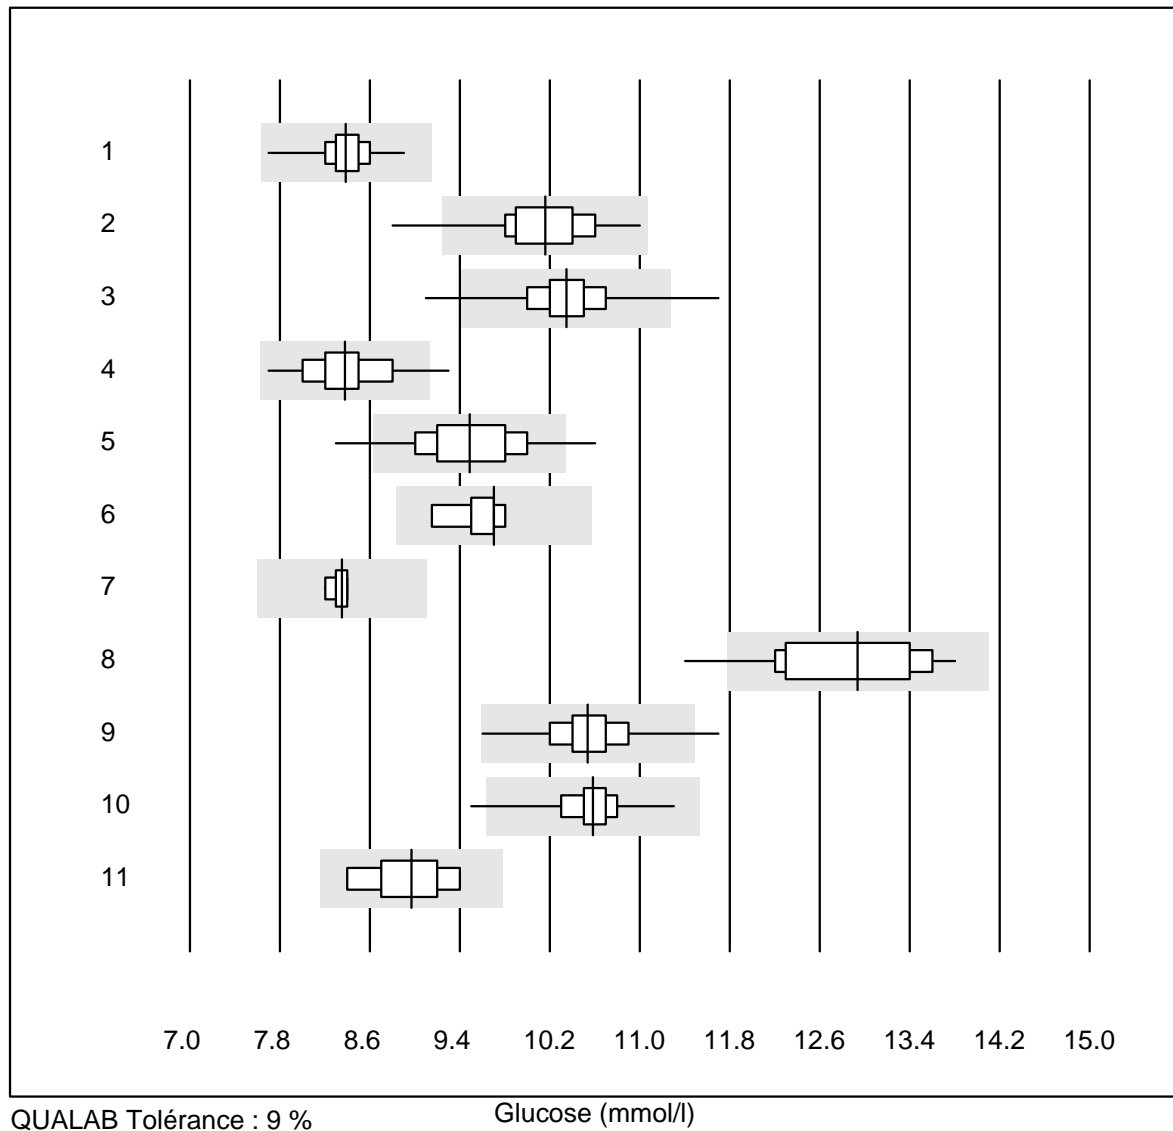

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	Accu-Chek Instant	71	100.0	0.0	0.0	8.4	2.3	e
2	Accu-Chek Aviva	254	92.1	1.2	6.7	10.2	3.4	e
3	Accu-Chek Inform 2	772	98.6	0.9	0.5	10.3	2.9	e
4	Accu-Check Guide	263	98.1	0.8	1.1	8.4	3.5	e
5	Contour XT	1348	95.2	3.1	1.7	9.5	4.2	e
6	Skyla	6	100.0	0.0	0.0	9.7	2.5	e
7	Statstrip/Xpress	6	100.0	0.0	0.0	8.4	1.0	e
8	Glucocard	11	90.9	9.1	0.0	12.9	5.5	e*
9	Hemocue 201+ P-equiv	102	98.0	1.0	1.0	10.5	2.8	e
10	Hemocue 201RT P-equi	125	96.8	0.8	2.4	10.6	2.3	e
11	Contour NEXT	11	100.0	0.0	0.0	9.0	4.0	e*


## Glucose

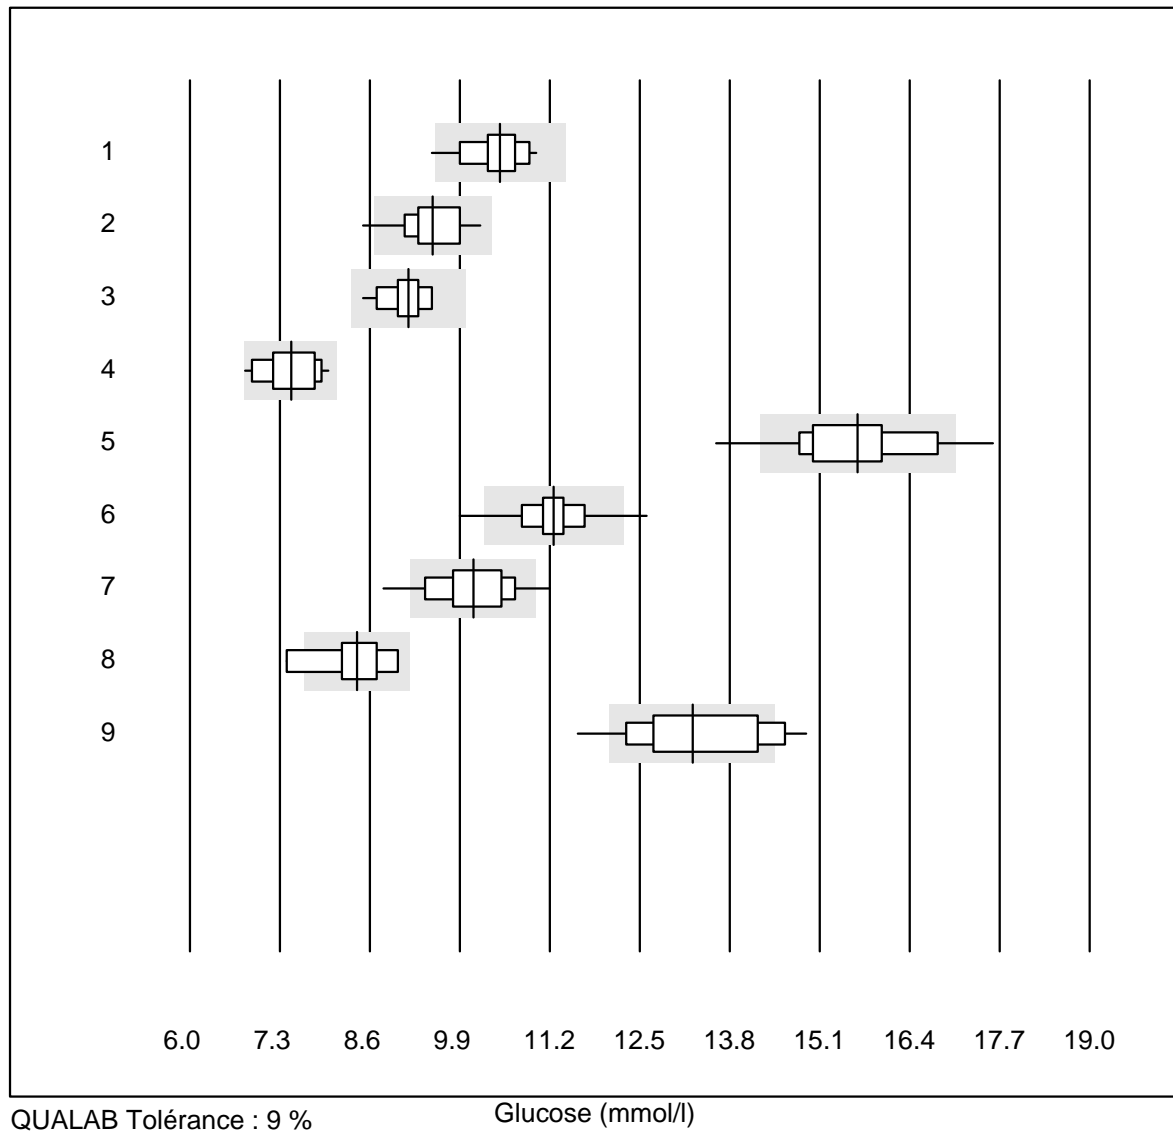

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Hemocue 201+ (alt)	38	97.4	2.6	0.0	10.5	3.2	e
2 AccuChek Sensor	31	93.6	3.2	3.2	9.5	4.0	e
3 OneTouch Verio	25	100.0	0.0	0.0	9.2	2.9	e
4 Contour 2 (5s)	14	92.9	0.0	7.1	7.5	5.1	e*
5 Healthpro	27	85.2	11.1	3.7	15.6	5.7	e*
6 Mylife UNIO	379	97.9	1.3	0.8	11.3	3.1	e
7 mylife Pura	84	91.7	7.1	1.2	10.1	5.2	e
8 Omnitest	15	53.3	6.7	40.0	8.4	5.6	e*
9 Alpha Check	22	54.6	13.6	31.8	13.3	7.0	e*



## Acide urique

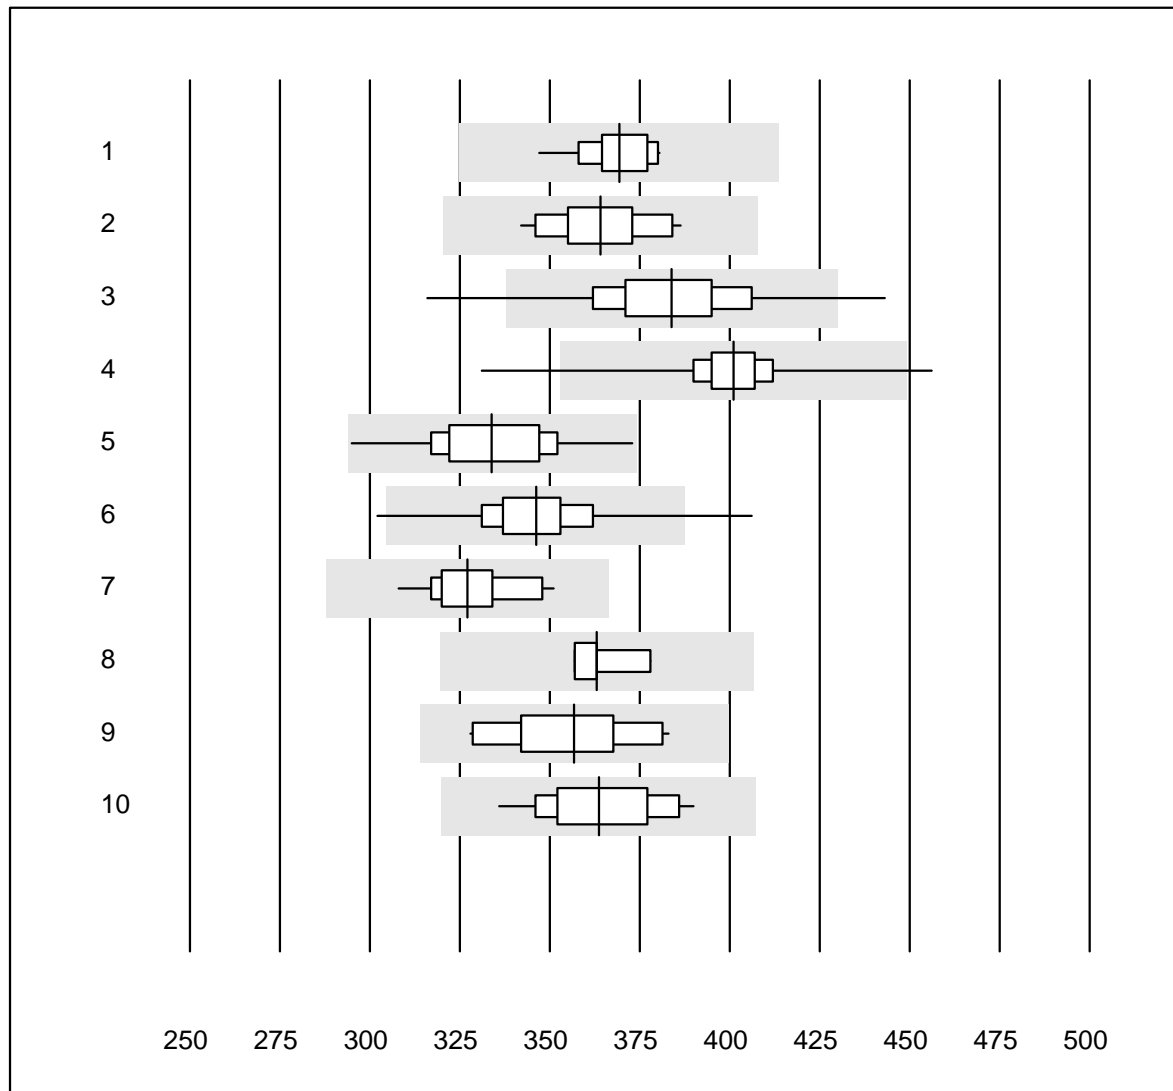


QUALAB Tolérance : 12 %

Acide urique (µmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	30	96.7	0.0	3.3	369	2.4	e
2 Cobas	19	100.0	0.0	0.0	364	3.3	e
3 Reflotron	420	95.7	1.0	3.3	384	4.7	e
4 Fuji Dri-Chem	901	99.5	0.2	0.3	401	2.4	e
5 Spotchem SP-4430	61	98.4	0.0	1.6	334	4.9	e
6 Spotchem D-Concept	368	97.3	1.9	0.8	346	4.1	e
7 Piccolo	32	96.9	0.0	3.1	327	3.4	e
8 Skyla	5	80.0	0.0	20.0	363	2.5	e
9 Selectra Pro	14	100.0	0.0	0.0	357	5.1	e
10 Autolyser/DiaSys	19	100.0	0.0	0.0	364	4.1	e

## Urée

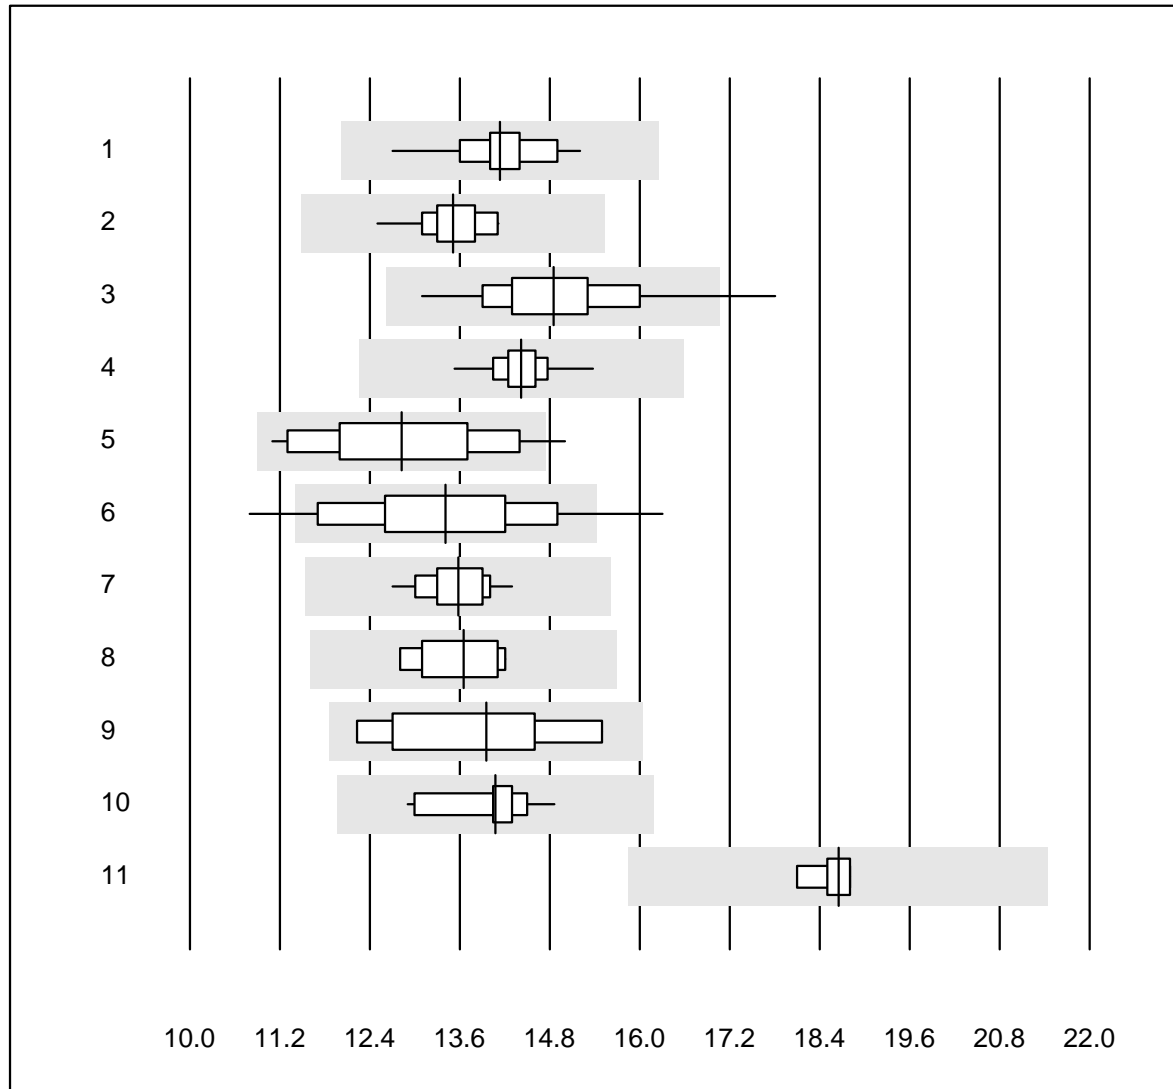


QUALAB Tolérance : 15 %

Urée (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	27	100.0	0.0	0.0	14.1	3.5	e
2 Cobas	19	100.0	0.0	0.0	13.5	2.9	e
3 Reflotron	202	95.5	2.5	2.0	14.8	5.8	e
4 Fuji Dri-Chem	551	99.5	0.0	0.5	14.4	2.0	e
5 Spotchem SP-4430	41	92.7	4.9	2.4	12.8	8.6	e
6 Spotchem D-Concept	221	88.3	9.0	2.7	13.4	9.0	e
7 Piccolo	59	96.6	0.0	3.4	13.6	2.9	e
8 Skyla	6	100.0	0.0	0.0	13.7	4.0	e
9 Selectra Pro	8	100.0	0.0	0.0	14.0	8.1	e*
10 Autolyser/DiaSys	14	100.0	0.0	0.0	14.1	3.8	e
11 iStat Chem8	6	83.3	0.0	16.7	18.7	1.6	e

## Potassium

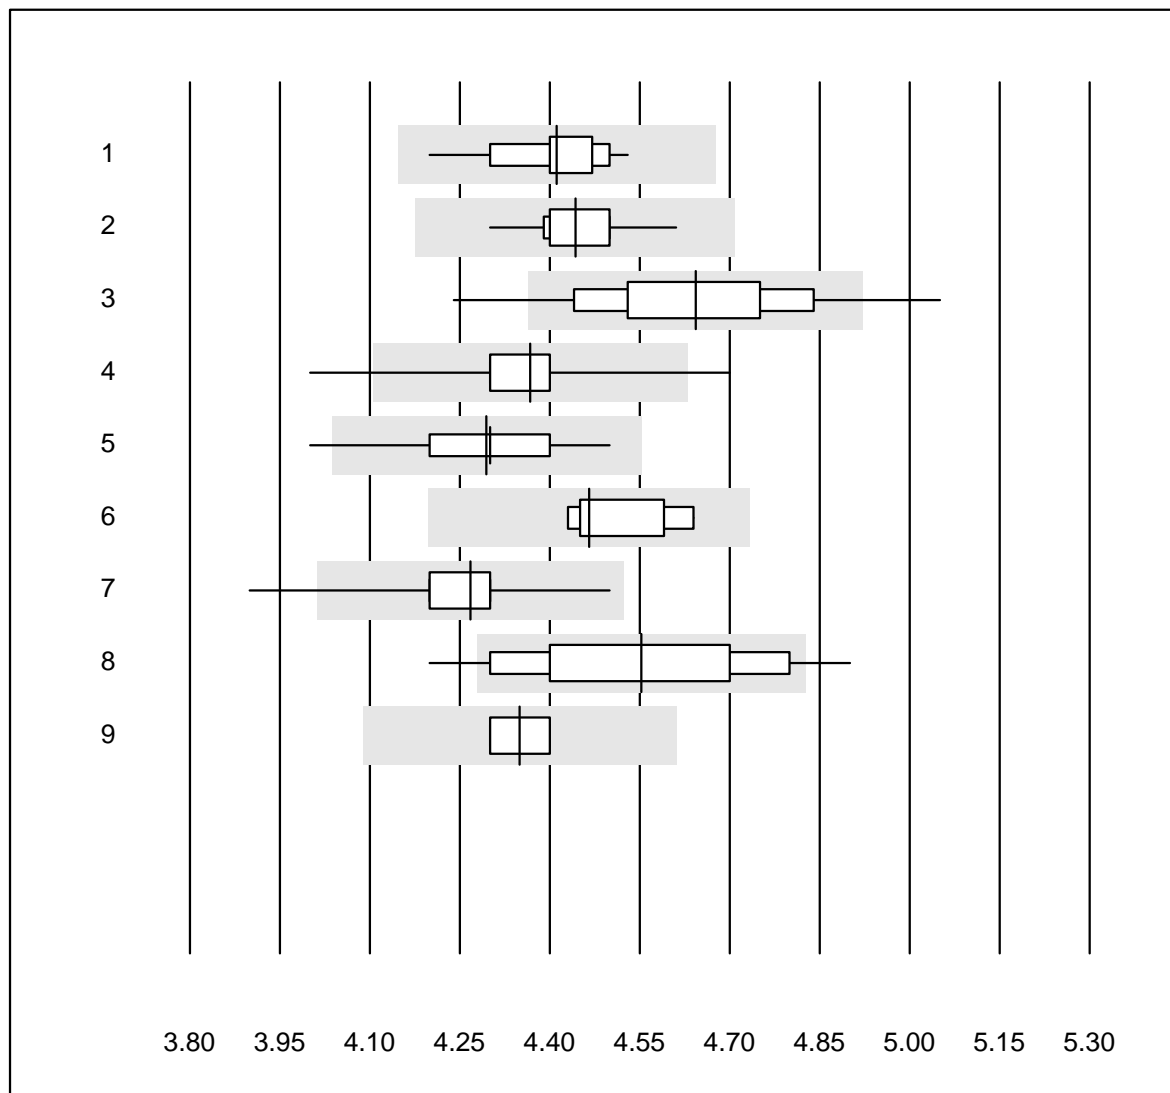


QUALAB Tolérance : 6 %

Potassium (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 ISE	39	100.0	0.0	0.0	4.41	1.8	e
2 Cobas	20	100.0	0.0	0.0	4.44	1.5	e
3 Reflotron	437	85.8	9.2	5.0	4.64	3.4	e
4 Fuji Dri-Chem	953	96.0	3.1	0.9	4.37	2.0	e
5 Spotchem D-Concept	372	97.6	0.8	1.6	4.29	1.8	e
6 Autolyser/DiaSys	6	83.3	0.0	16.7	4.47	2.0	e*
7 Spotchem EL-SE 1520	63	95.2	3.2	1.6	4.27	2.3	e
8 Piccolo	44	79.5	11.4	9.1	4.55	4.2	e
9 iStat Chem8	8	100.0	0.0	0.0	4.35	1.2	e

## Créatinine

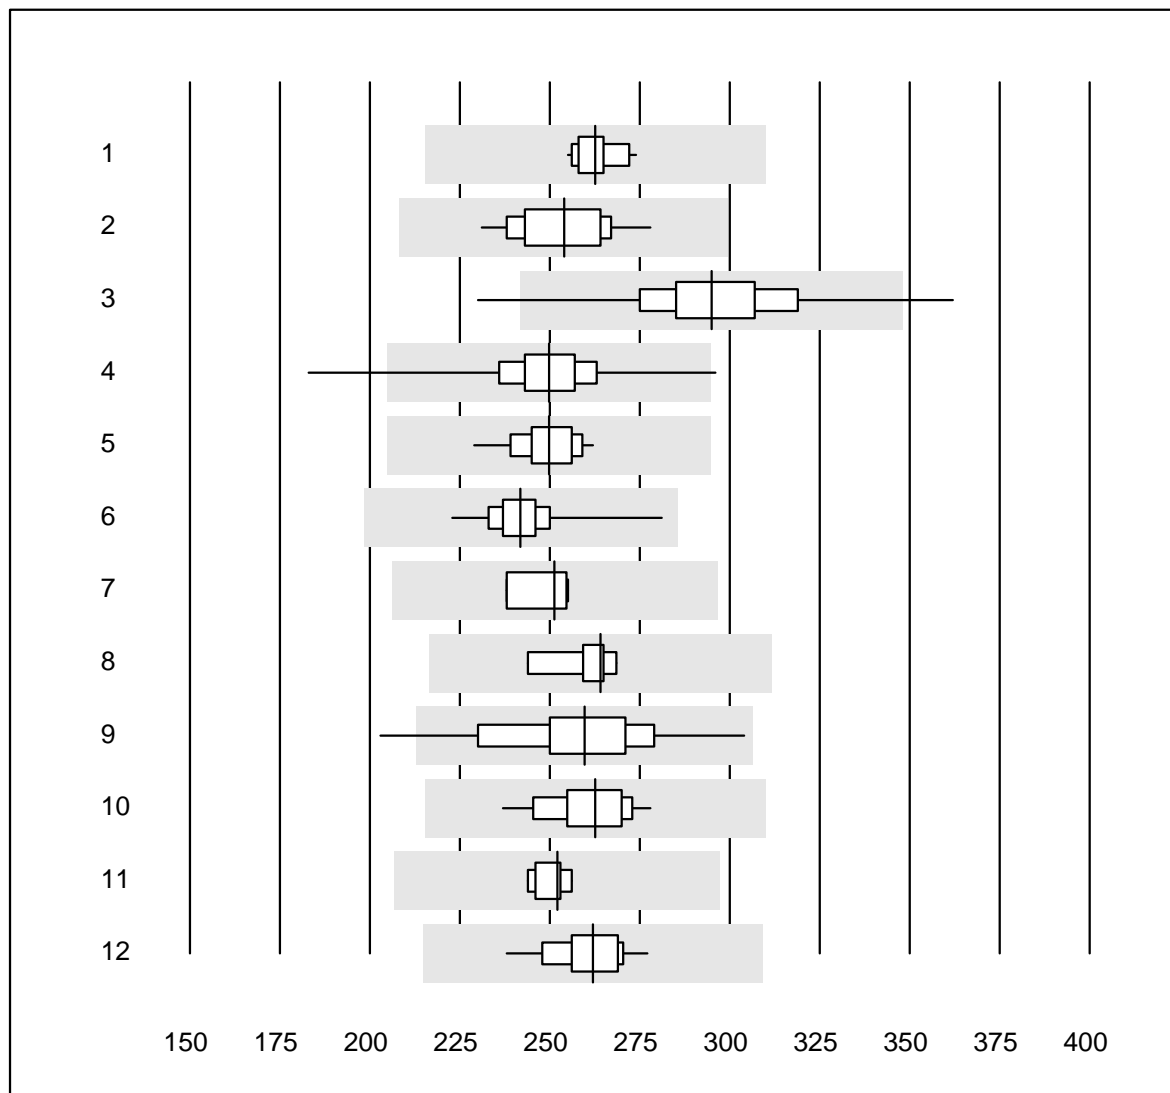


QUALAB Tolérance : 18 %

Créatinine (µmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	13	100.0	0.0	0.0	263	2.3	e
2 Cobas	20	100.0	0.0	0.0	254	5.1	e
3 Reflotron	603	96.0	1.2	2.8	295	6.0	e
4 Fuji Dri-Chem	993	99.4	0.2	0.4	250	4.2	e
5 Spotchem SP-4430	85	98.8	0.0	1.2	250	3.0	e
6 Spotchem D-Concept	396	98.5	0.0	1.5	242	3.0	e
7 Jaffé Boehringer	4	100.0	0.0	0.0	251	3.2	e
8 Enzymatisch	9	100.0	0.0	0.0	264	3.4	e
9 Piccolo	65	93.8	3.1	3.1	260	7.2	e
10 Selectra Pro	17	100.0	0.0	0.0	263	4.2	e
11 Skyla	5	100.0	0.0	0.0	252	2.0	e
12 Autolyser/DiaSys	20	100.0	0.0	0.0	262	3.6	e
13 Autres méthodes	5	100.0	0.0	0.0	260	1.5	e
14 EPOC	11	90.9	0.0	9.1	279	4.2	e

## Créatinine E

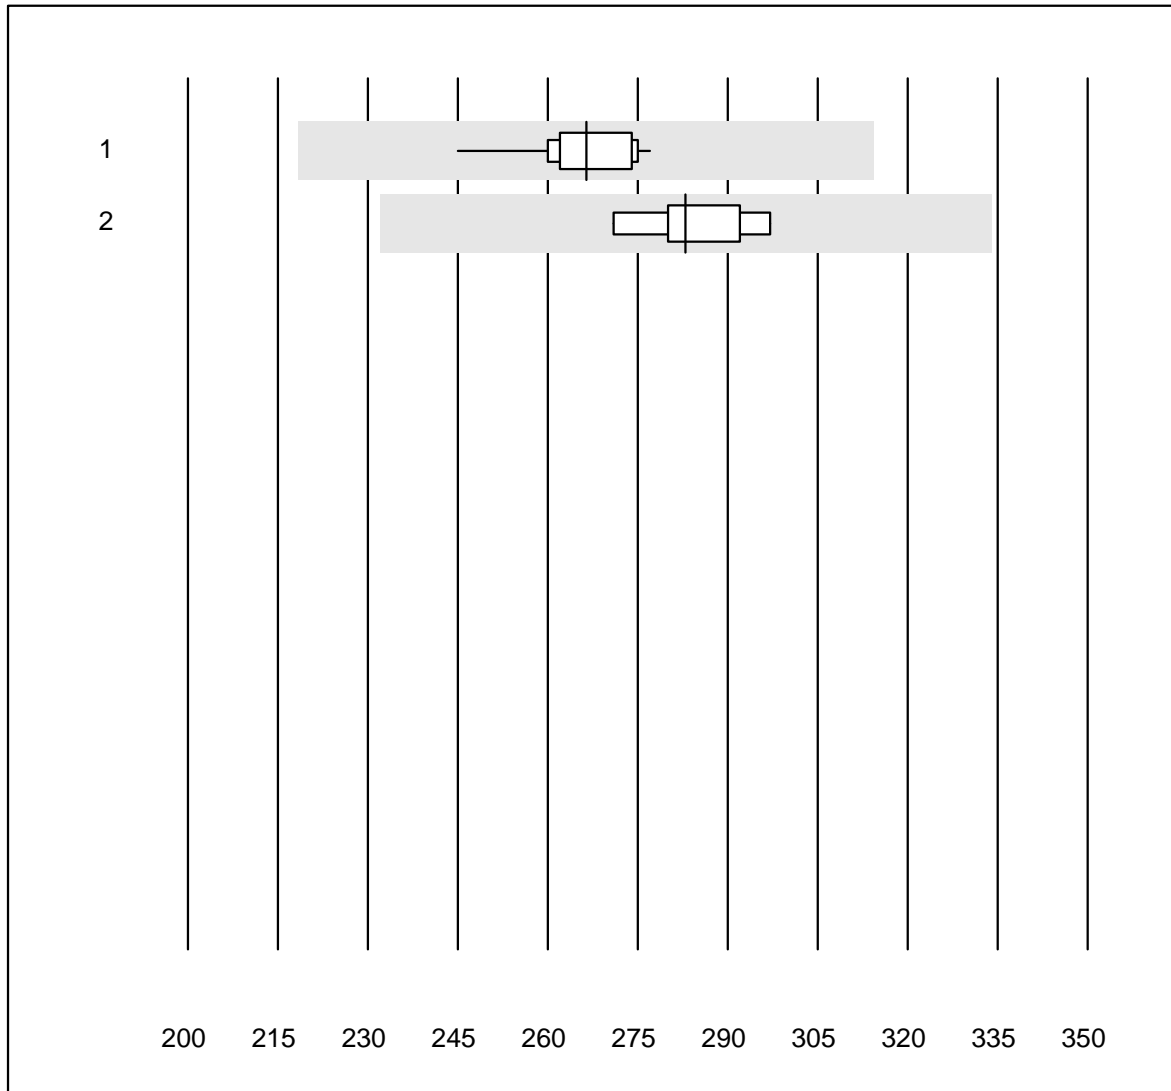


QUALAB Tolérance : 18 %

Créatinine E (µmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 iStat Chem8	13	100.0	0.0	0.0	266	3.3	e
2 ABL700/800	7	100.0	0.0	0.0	283	2.9	e

## eGFR CKD-EPI

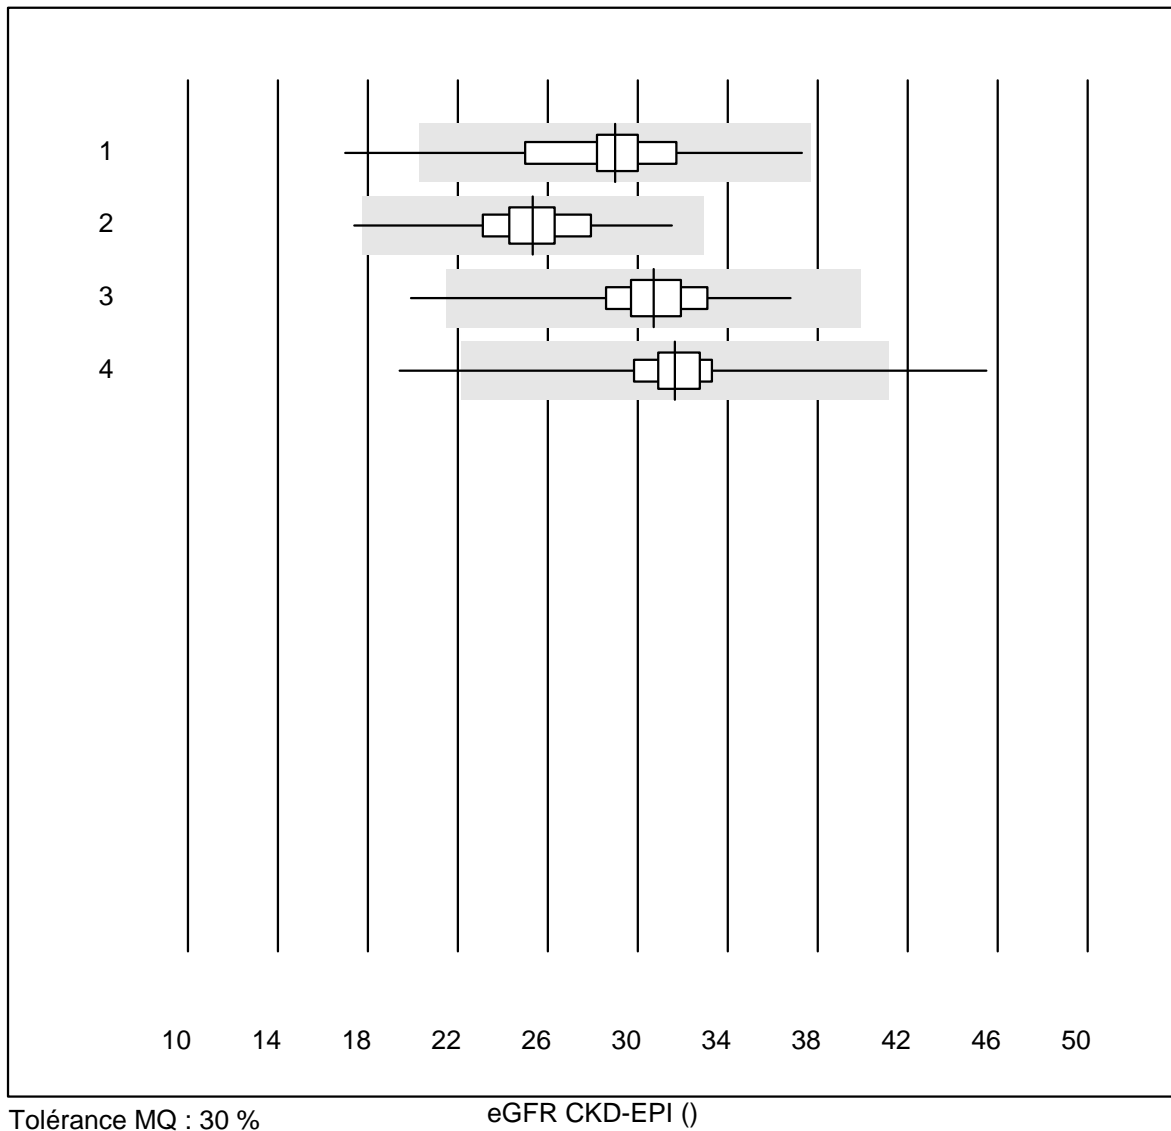


Tolérance MQ : 30 %

eGFR CKD-EPI ( )

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	61	88.5	4.9	6.6	29	12.1	e
2 Reflotron	167	97.0	0.6	2.4	25	7.7	e
3 Fuji Dri-Chem	372	95.4	1.6	3.0	31	7.4	e
4 Spotchem test	173	91.4	1.7	6.9	32	8.3	e

## eGFR Cockcroft-Gault

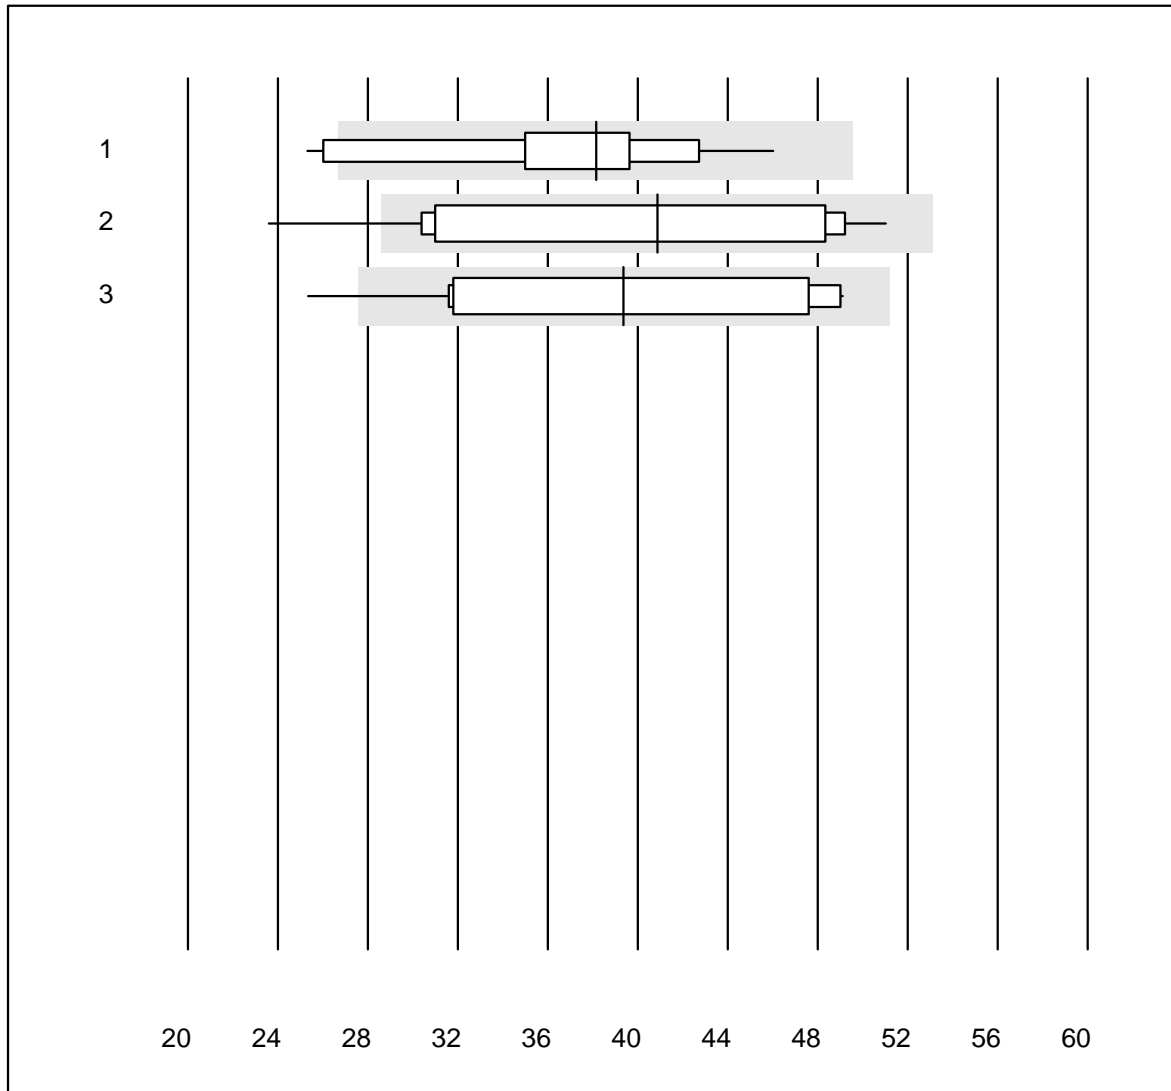


Tolérance MQ : 30 %

eGFR Cockcroft-Gault ()

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Reflotron	17	82.3	11.8	5.9	38	14.7	e
2 Fuji Dri-Chem	37	94.6	5.4	0.0	41	20.9	e
3 Spotchem test	14	78.6	7.1	14.3	39	22.8	e*

## eGFR MDRD

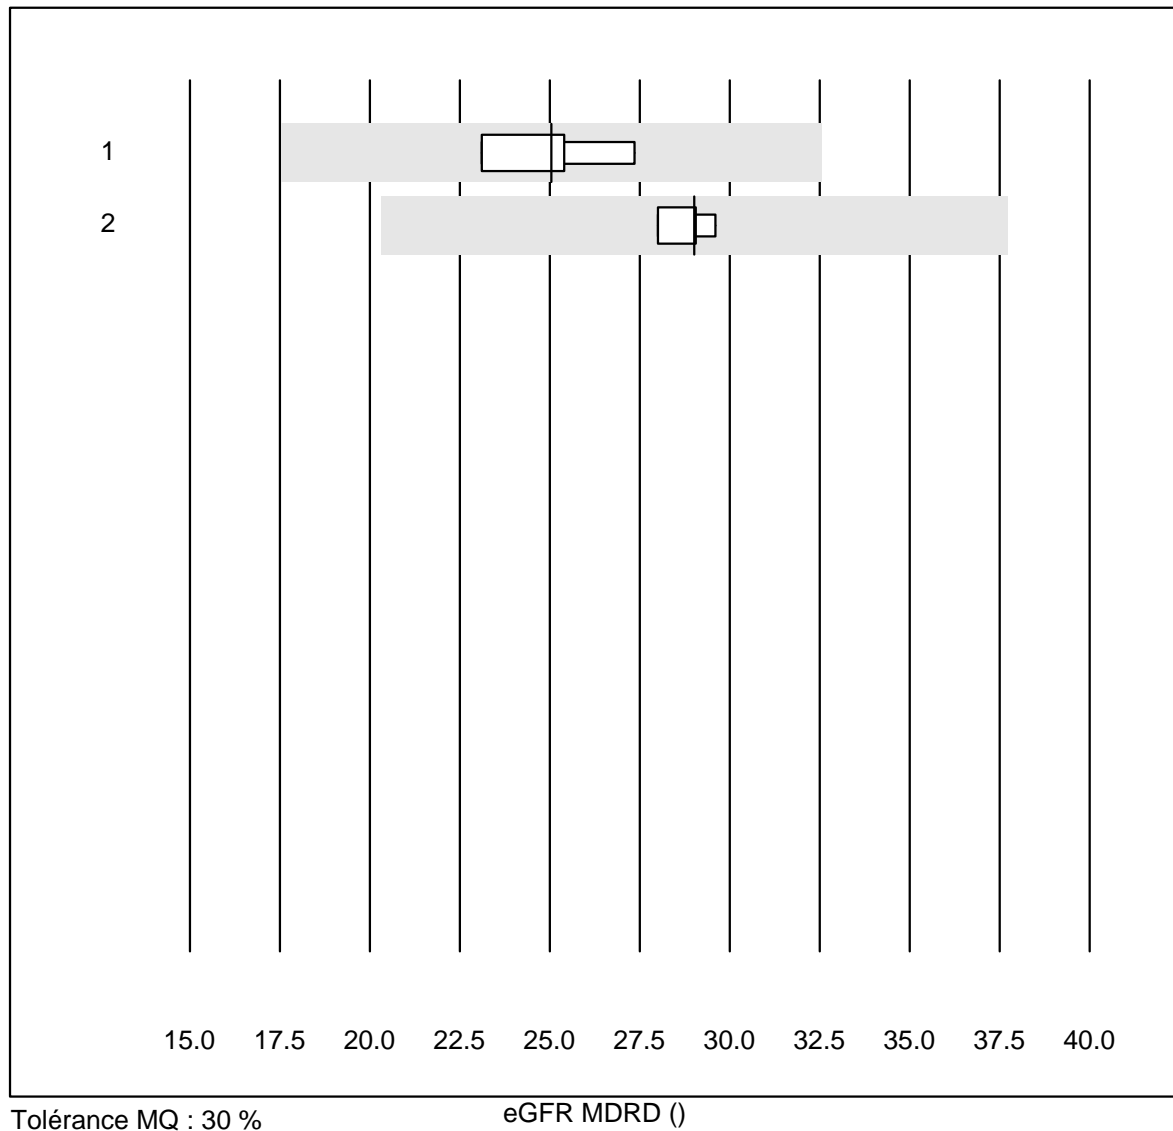


Tolérance MQ : 30 %

eGFR MDRD ()

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Reflotron	4	100.0	0.0	0.0	25	7.0	e
2 Fuji Dri-Chem	4	100.0	0.0	0.0	29	2.3	e



## LDH

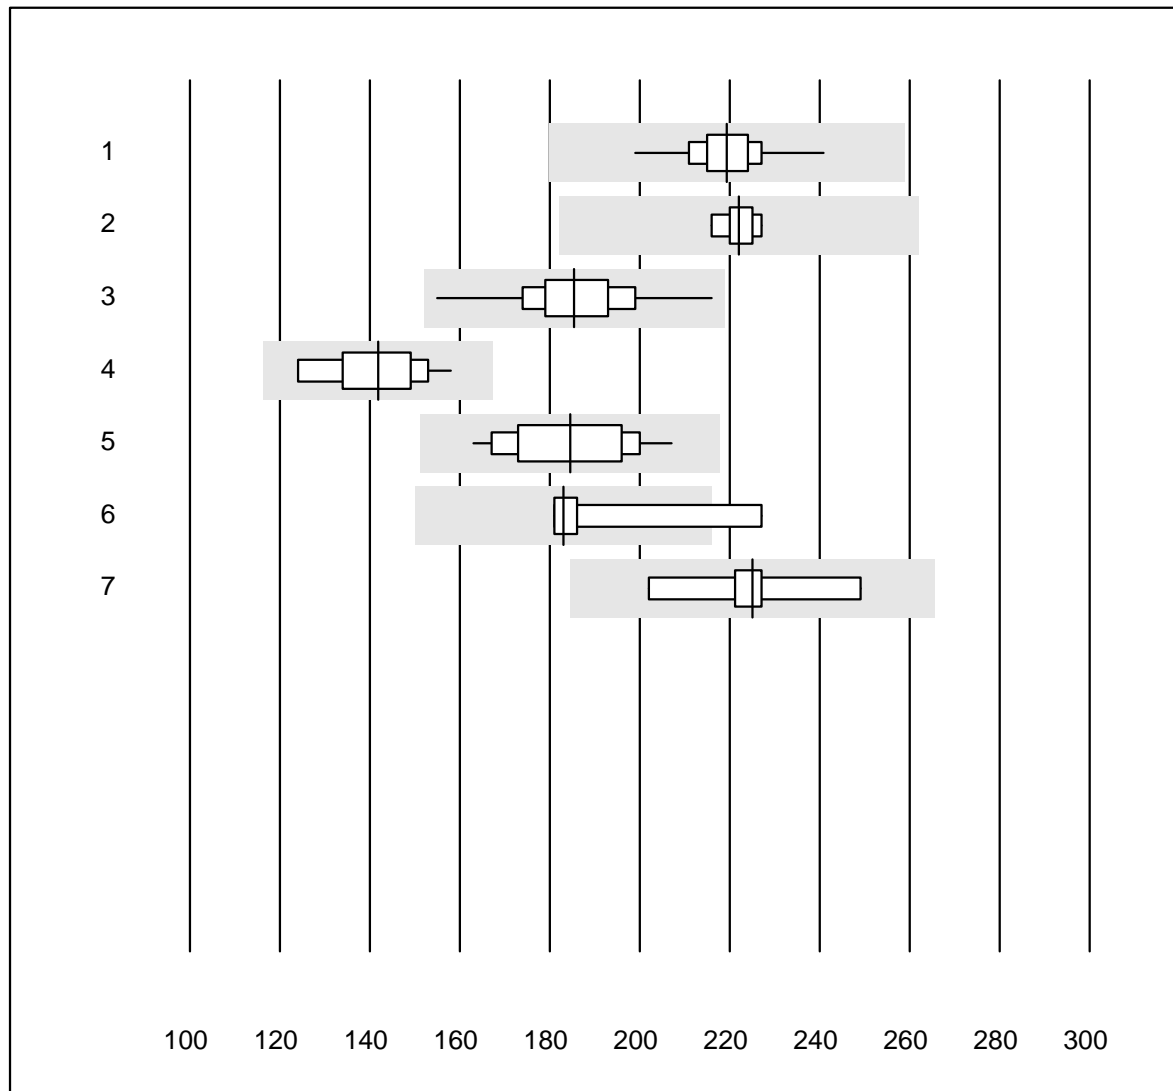


QUALAB Tolérance : 18 %

LDH (U/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 IFCC	36	100.0	0.0	0.0	219	3.4	e
2 Cobas	6	100.0	0.0	0.0	222	1.8	e
3 Fuji Dri-Chem	143	96.5	0.0	3.5	185	5.3	e
4 Spotchem SP-4430	11	90.9	0.0	9.1	142	8.0	e*
5 Spotchem D-Concept	46	97.8	0.0	2.2	185	6.6	e
6 Piccolo	6	83.3	16.7	0.0	183	9.5	e*
7 Autolyser/DiaSys	9	100.0	0.0	0.0	225	6.3	e

## Magnésium

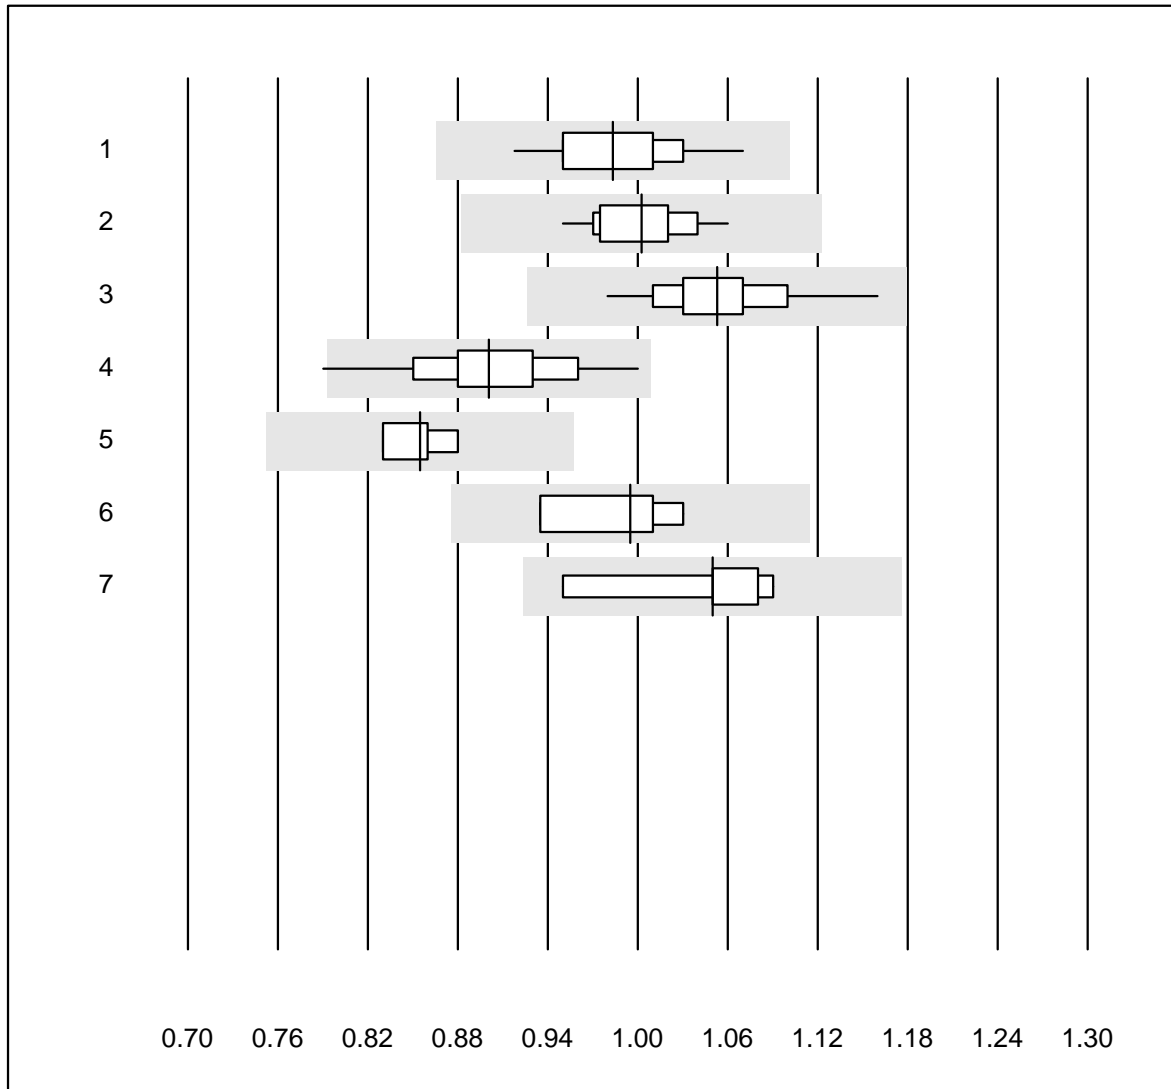


QUALAB Tolérance : 12 %

Magnésium (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	20	100.0	0.0	0.0	0.98	4.1	e
2 Cobas	14	100.0	0.0	0.0	1.00	3.1	e
3 Fuji Dri-Chem	108	100.0	0.0	0.0	1.05	3.2	e
4 Spotchem D-Concept	41	97.6	2.4	0.0	0.90	4.6	e
5 Spotchem SP-4430	4	100.0	0.0	0.0	0.86	2.4	e
6 Beckman	4	100.0	0.0	0.0	1.00	4.2	e*
7 Piccolo	7	100.0	0.0	0.0	1.05	4.4	e*

## Sodium

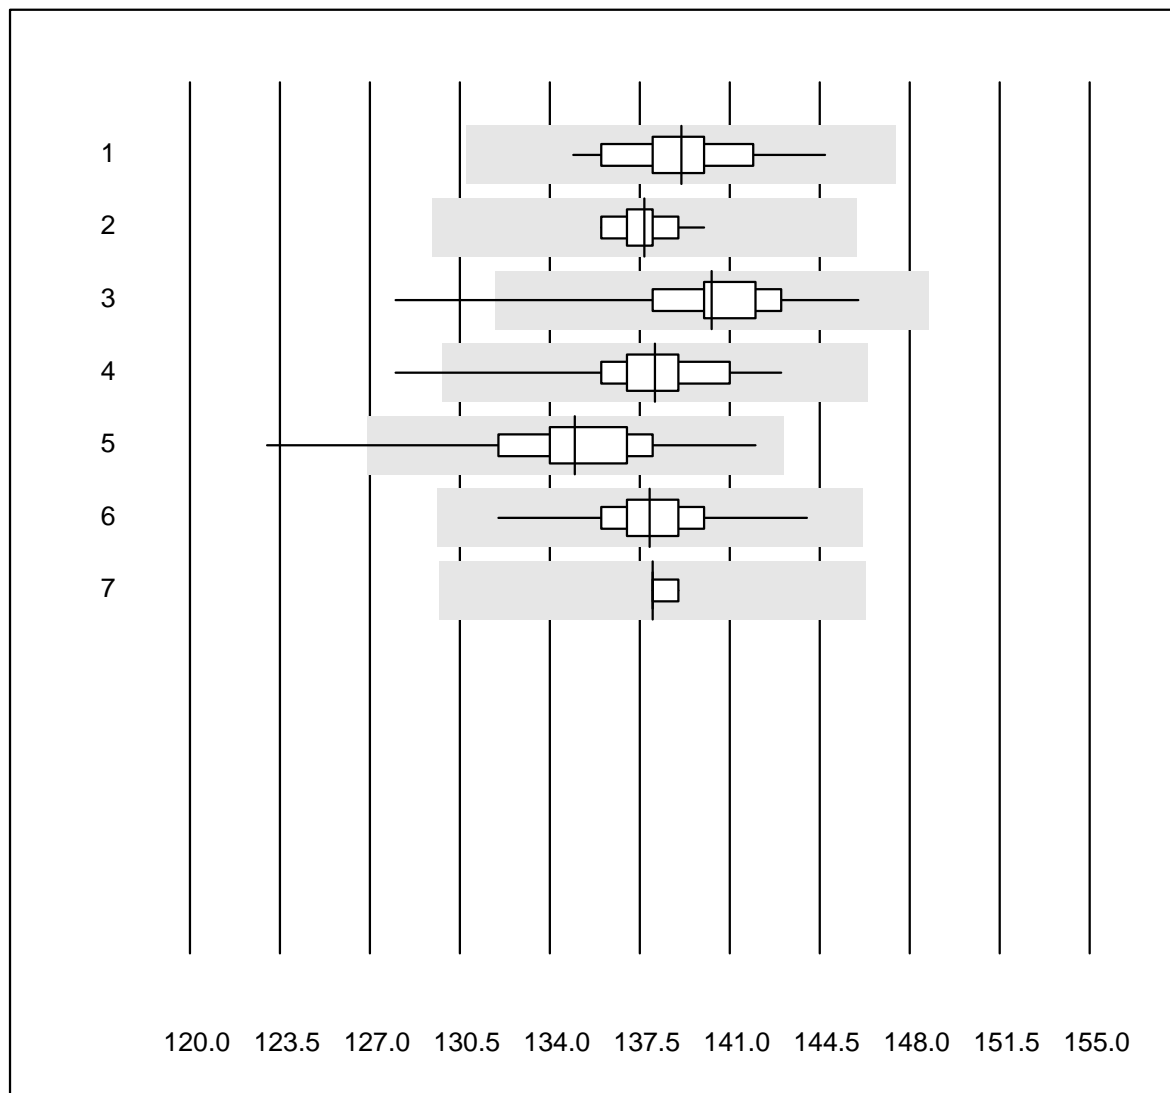


QUALAB Tolérance : 6 %

Sodium (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 ISE	38	97.4	0.0	2.6	139	1.5	e
2 Cobas	20	100.0	0.0	0.0	138	0.9	e
3 Fuji Dri-Chem	885	98.3	1.0	0.7	140	1.7	e
4 Spotchem D-Concept	349	98.8	0.3	0.9	138	1.3	e
5 Spotchem EL-SE 1520	61	96.7	3.3	0.0	135	2.3	e
6 Piccolo	45	100.0	0.0	0.0	138	1.5	e
7 iStat Chem8	7	100.0	0.0	0.0	138	0.3	e

## Phosphates

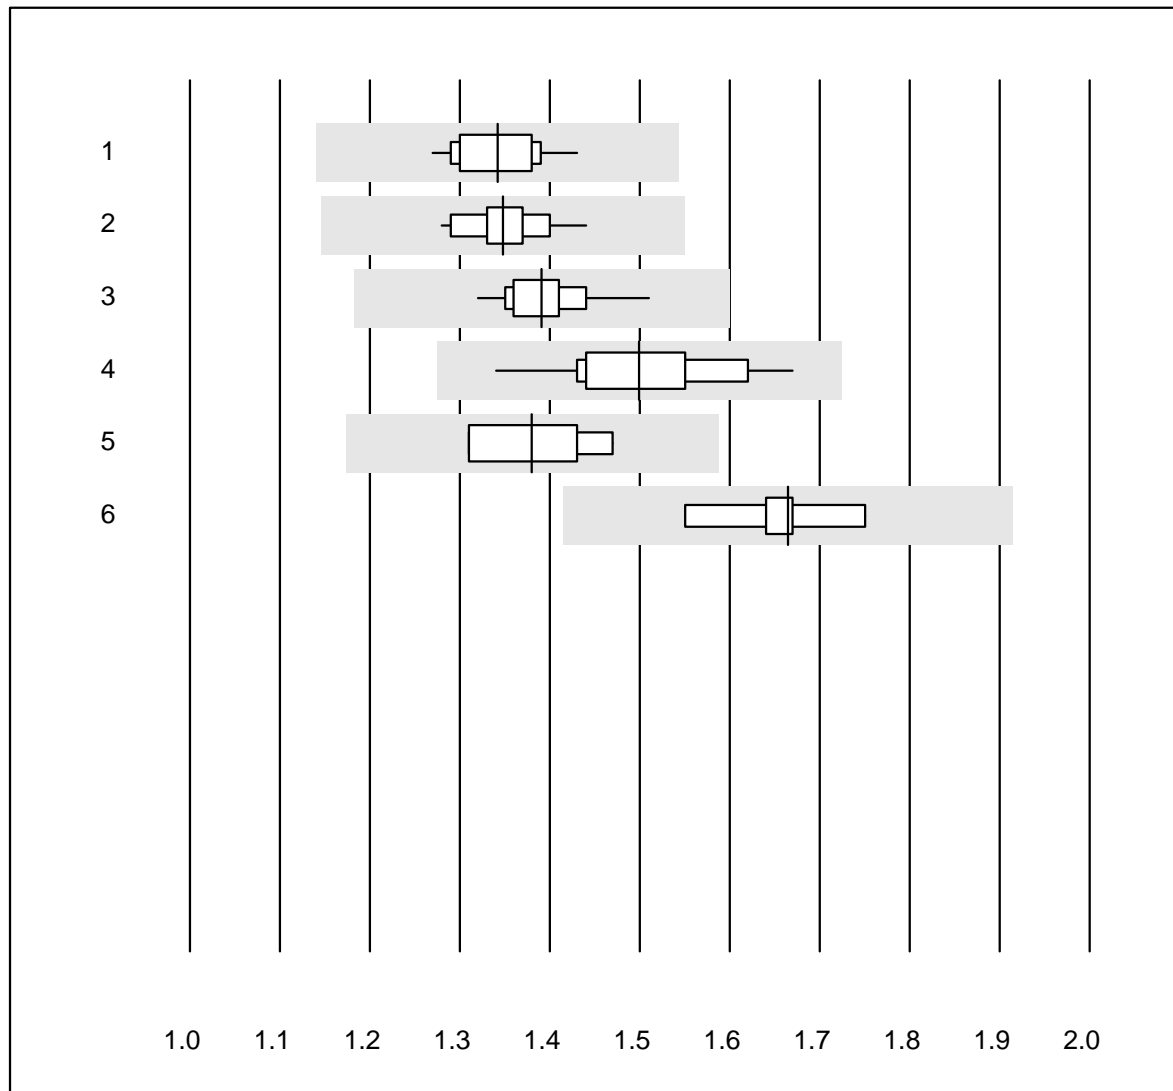


QUALAB Tolérance : 15 %

Phosphates (mmol/l)


No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	Chimie humide	22	100.0	0.0	0.0	1.3	3.4	e
2	Cobas	17	100.0	0.0	0.0	1.3	3.0	e
3	Fuji Dri-Chem	83	98.8	0.0	1.2	1.4	2.8	e
4	Spotchem D-Concept	17	100.0	0.0	0.0	1.5	5.5	e
5	Spotchem SP-4430	4	100.0	0.0	0.0	1.4	5.6	e*
6	Piccolo	8	100.0	0.0	0.0	1.7	3.7	e

## Protéine

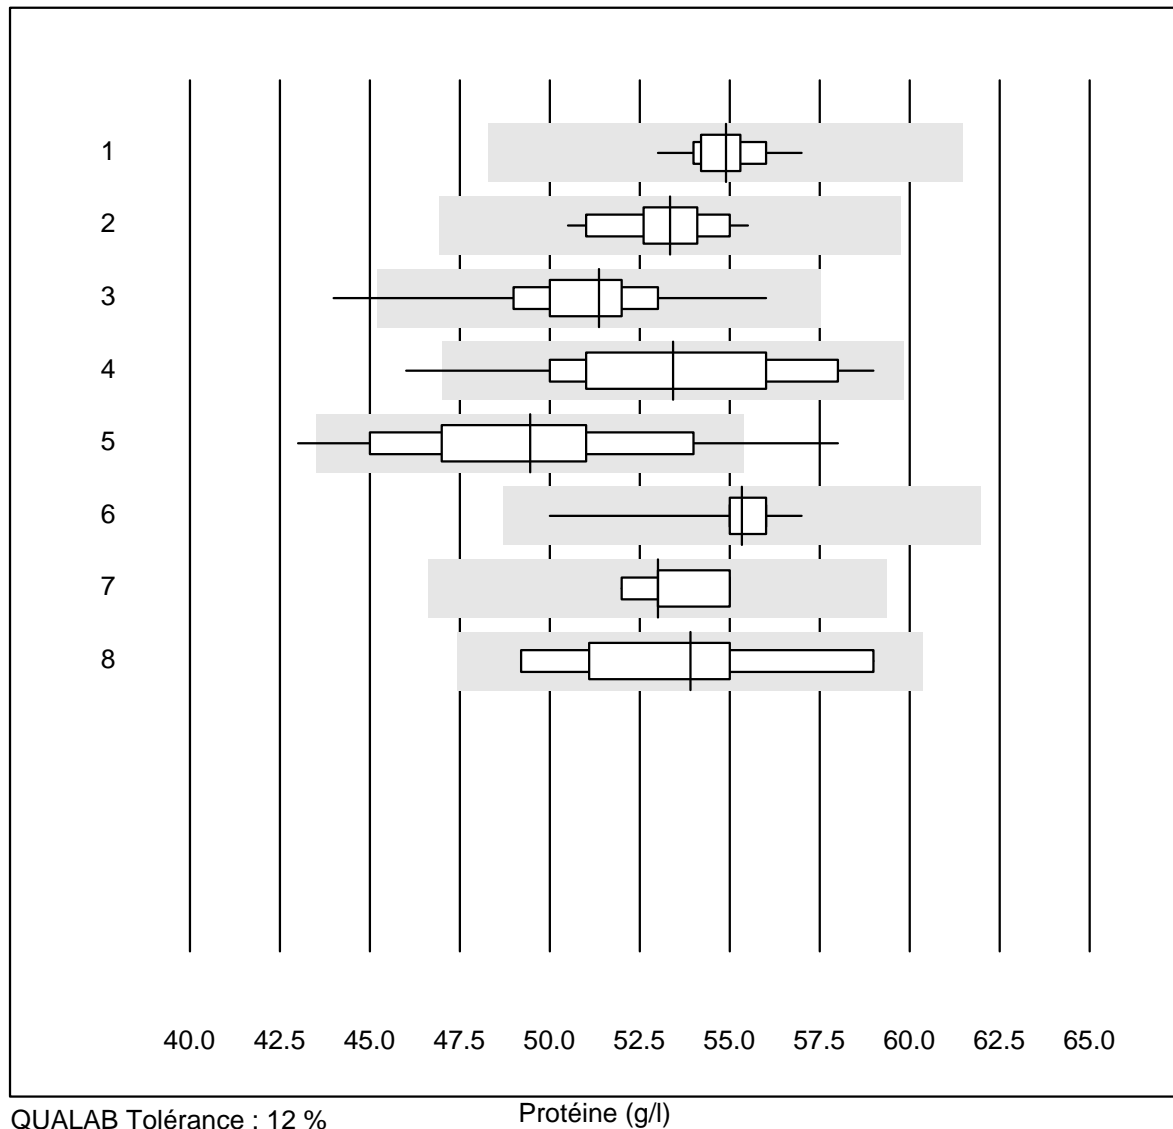

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	23	100.0	0.0	0.0	54.9	1.7	e
2 Cobas	17	100.0	0.0	0.0	53.3	2.8	e
3 Fuji Dri-Chem	185	97.9	0.5	1.6	51.4	3.2	e
4 Spotchem SP-4430	26	84.7	3.8	11.5	53.4	6.0	e
5 Spotchem D-Concept	138	91.3	6.5	2.2	49.5	6.6	e
6 Piccolo	47	97.9	0.0	2.1	55.3	1.9	e
7 Skyla	5	100.0	0.0	0.0	53.0	2.5	e
8 Selectra Pro	8	100.0	0.0	0.0	53.9	6.2	e*

## Transaminase GOT/AST

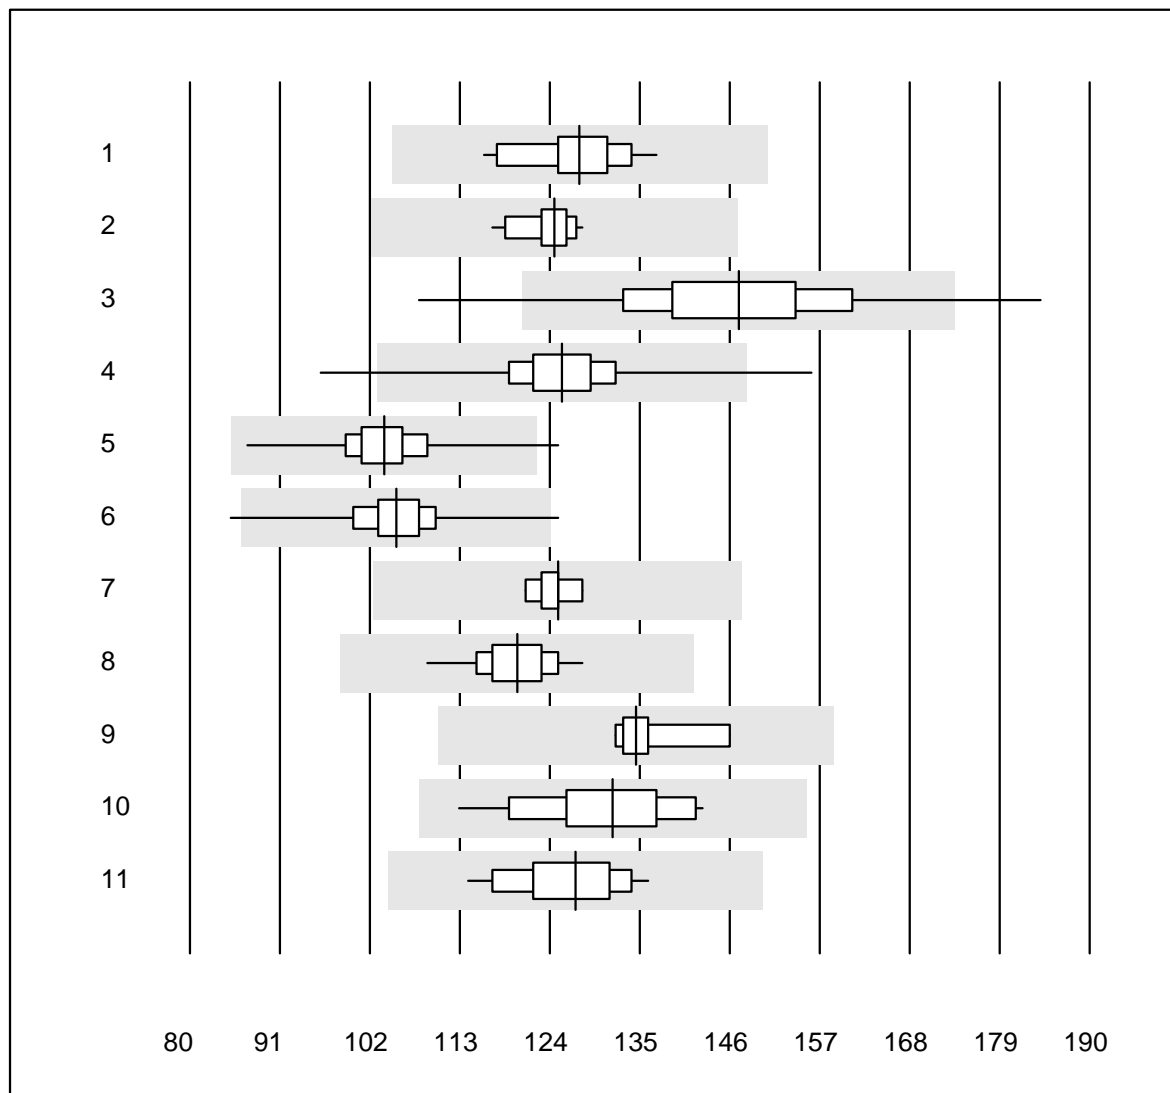


QUALAB Tolérance : 18 %

Transaminase GOT/AST (U/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 IFCC avec PP	27	100.0	0.0	0.0	128	4.3	e
2 Cobas	16	100.0	0.0	0.0	125	2.5	e
3 Reflotron	515	95.4	2.1	2.5	147	7.4	e
4 Fuji Dri-Chem	976	98.9	0.4	0.7	126	4.3	e
5 Spotchem SP-4430	84	97.6	1.2	1.2	104	4.8	e
6 Spotchem D-Concept	393	98.5	0.5	1.0	105	4.6	e
7 IFCC sens PP	6	100.0	0.0	0.0	125	1.9	e
8 Piccolo	69	100.0	0.0	0.0	120	3.2	e
9 Skyla	6	100.0	0.0	0.0	135	3.7	e
10 Selectra Pro	15	100.0	0.0	0.0	132	6.2	e
11 Autolyser/DiaSys	20	100.0	0.0	0.0	127	5.0	e

## Transaminase GPT/ALT

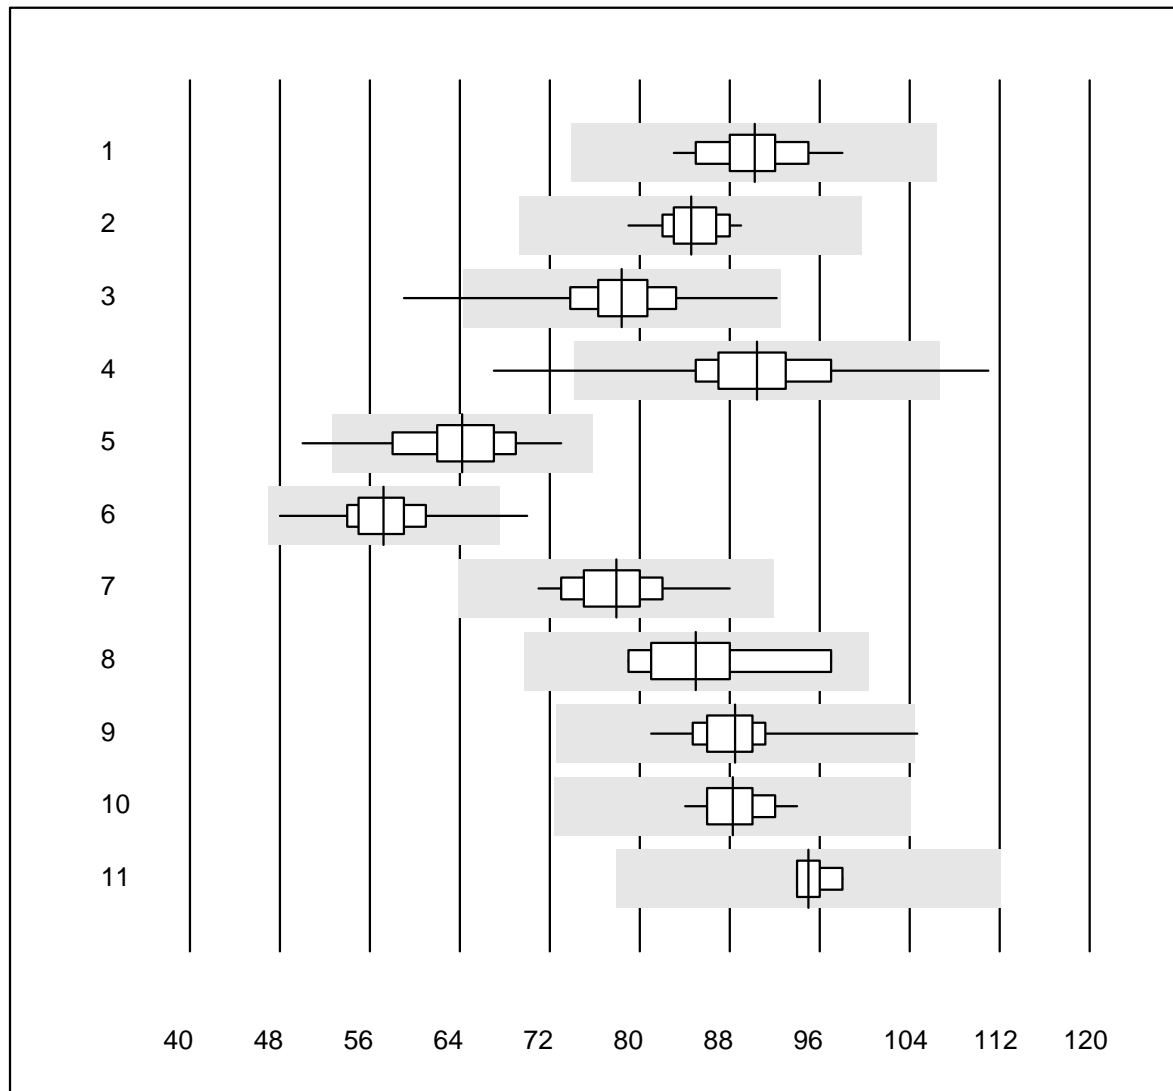


QUALAB Tolérance : 18 %

Transaminase GPT/ALT (U/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 IFCC avec PP	22	100.0	0.0	0.0	90	4.1	e
2 Cobas	22	100.0	0.0	0.0	85	2.9	e
3 Reflotron	528	97.4	1.1	1.5	78	5.4	e
4 Fuji Dri-Chem	988	98.8	0.4	0.8	90	5.3	e
5 Spotchem SP-4430	86	97.6	1.2	1.2	64	6.6	e
6 Spotchem D-Concept	396	97.5	0.5	2.0	57	5.6	e
7 Piccolo	66	100.0	0.0	0.0	78	4.7	e
8 Skyla	6	100.0	0.0	0.0	85	7.4	e*
9 Selectra Pro	15	93.3	6.7	0.0	88	5.8	e
10 Autolyser/DiaSys	20	100.0	0.0	0.0	88	3.0	e
11 Autres méthodes	5	100.0	0.0	0.0	95	1.8	e

## Triglycérides

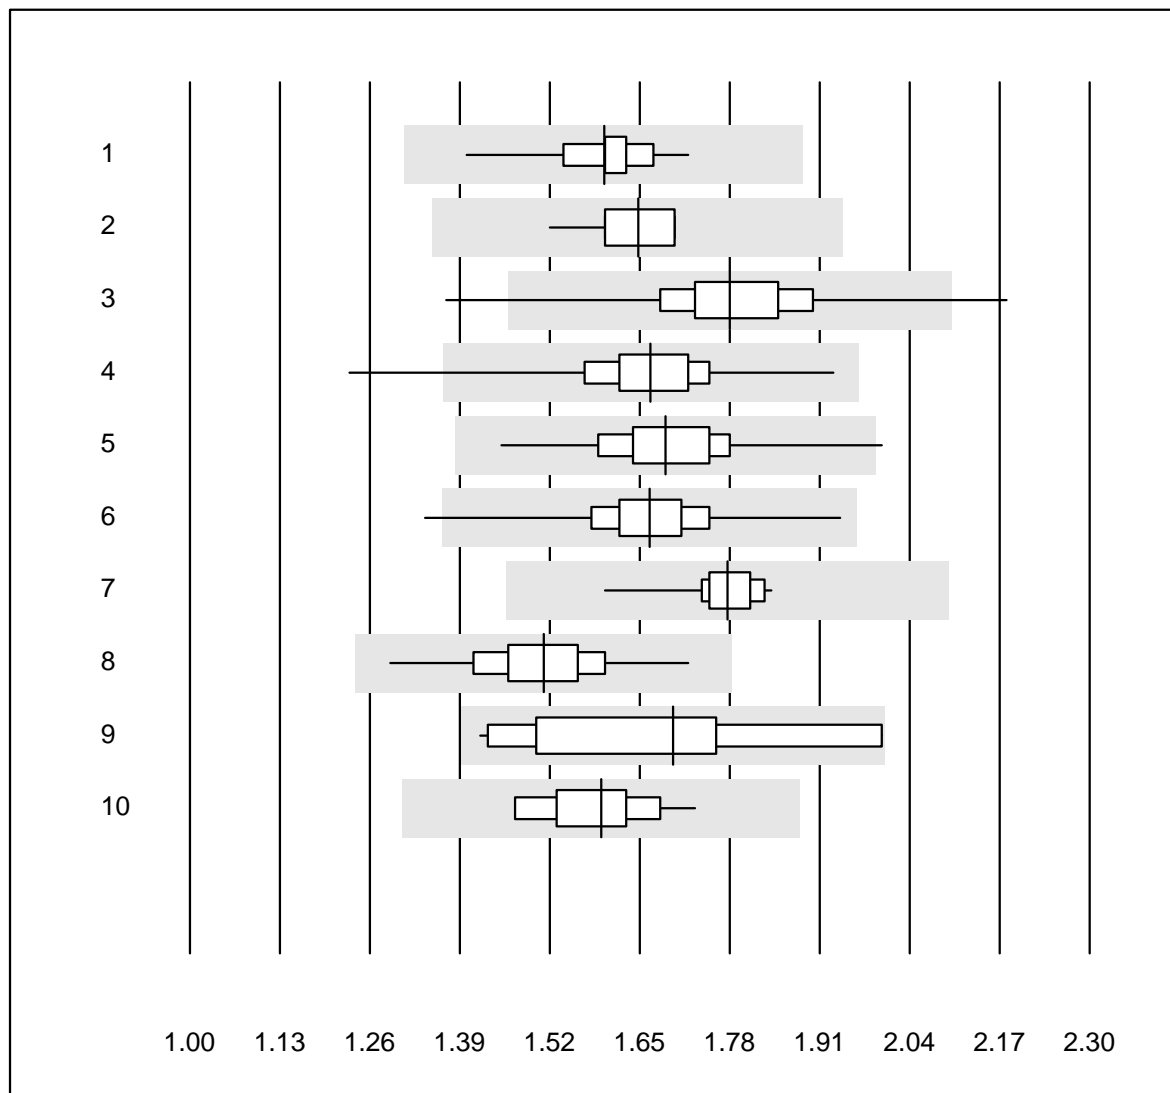


QUALAB Tolérance : 18 %

Triglycérides (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	25	100.0	0.0	0.0	1.60	4.3	e
2 Cobas	21	100.0	0.0	0.0	1.65	3.1	e
3 Reflotron	223	92.9	2.2	4.9	1.78	6.1	e
4 Fuji Dri-Chem	842	98.4	0.4	1.2	1.67	4.4	e
5 Spotchem SP-4430	67	98.5	1.5	0.0	1.69	5.2	e
6 Spotchem D-Concept	345	96.2	0.3	3.5	1.66	4.5	e
7 Piccolo	23	100.0	0.0	0.0	1.78	2.8	e
8 Cholestech LDX	308	98.7	0.0	1.3	1.51	4.9	e
9 Selectra Pro	12	100.0	0.0	0.0	1.70	12.6	e*
10 Autolyser/DiaSys	20	100.0	0.0	0.0	1.59	4.5	e



## Lithium

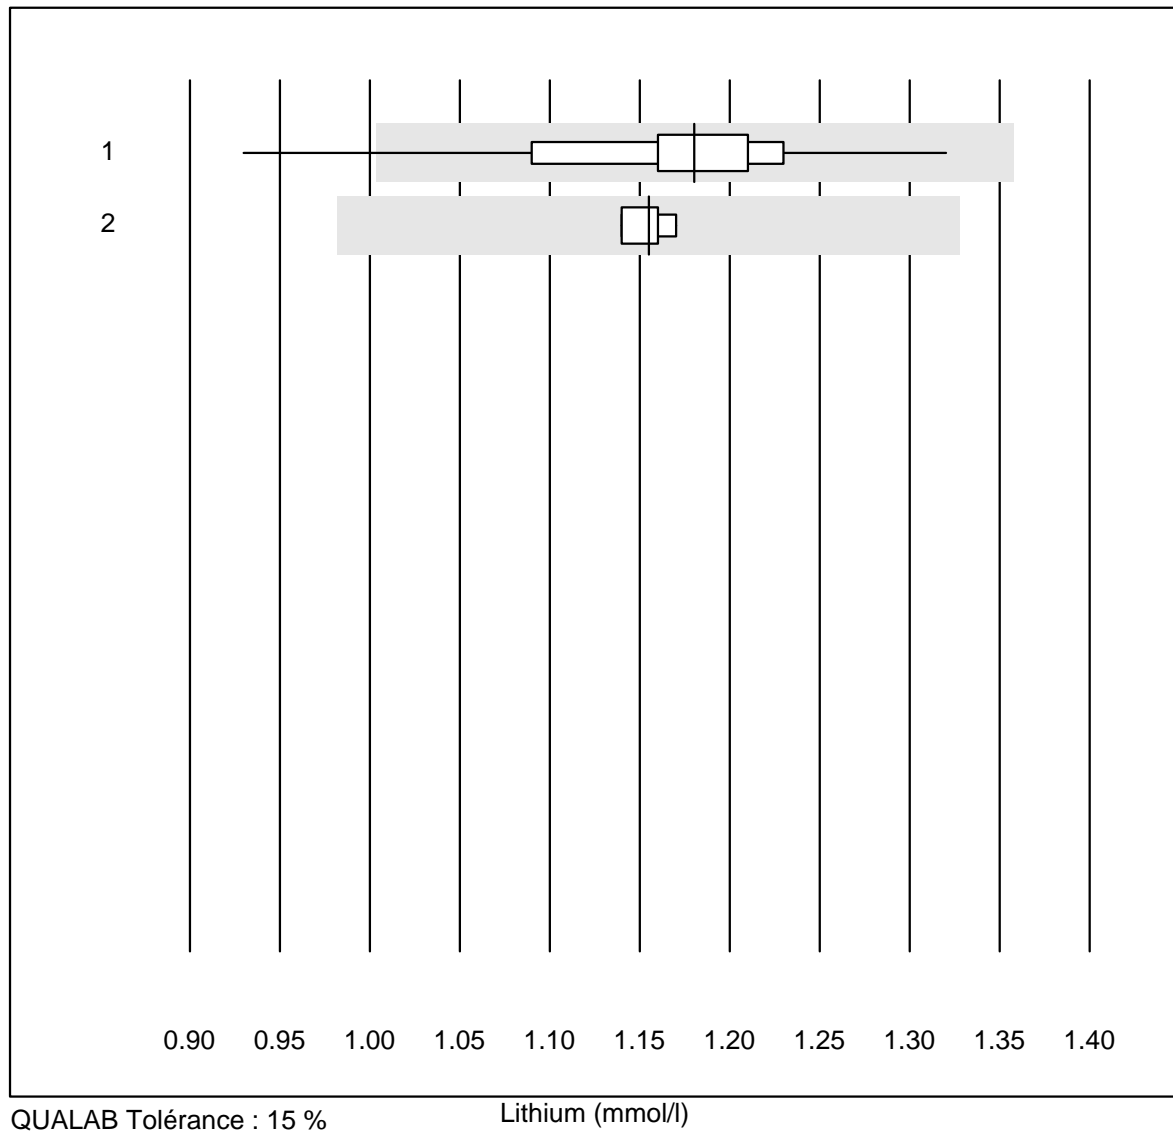


QUALAB Tolérance : 15 %

Lithium (mmol/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	18	94.4	5.6	0.0	1.18	6.6	e
2 Cobas Integra 800/40	4	100.0	0.0	0.0	1.16	1.1	e

## Laktat

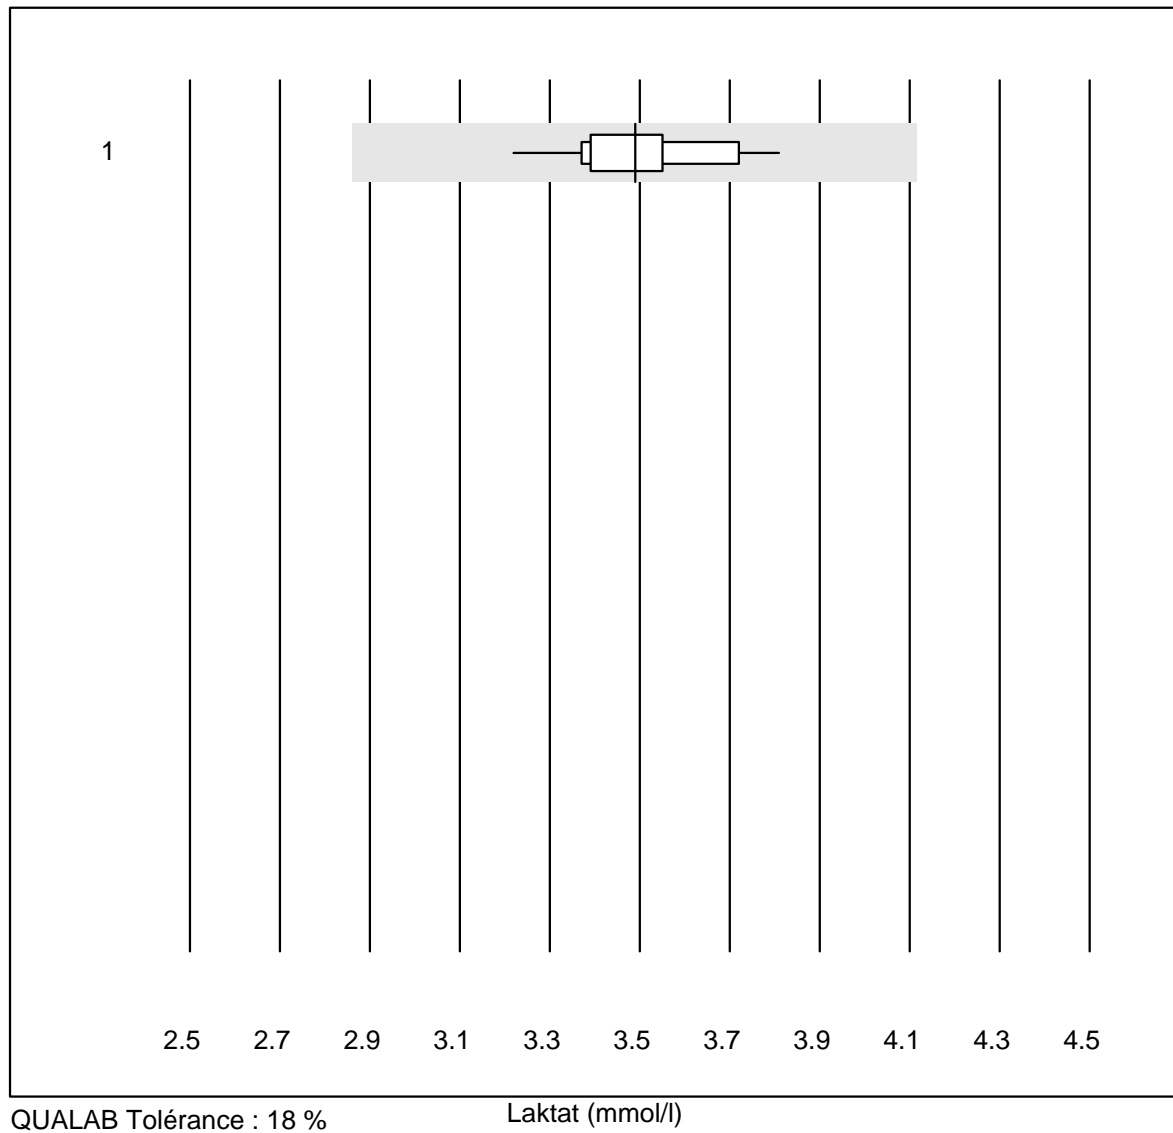

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	14	100.0	0.0	0.0	3.49	4.2	e

## HbA1c échantillon A

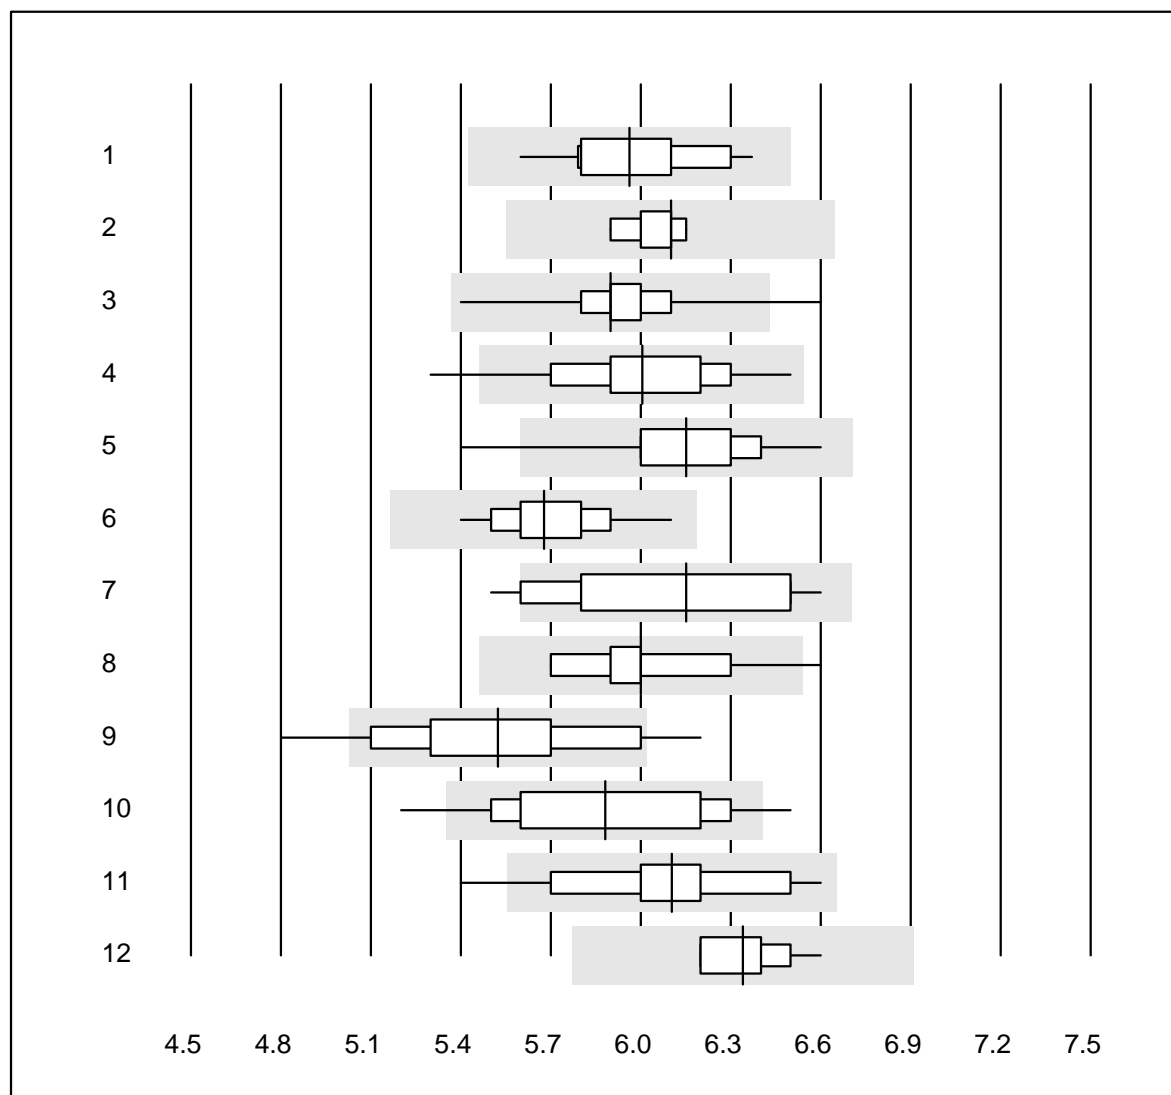


QUALAB Tolérance : 9 %

HbA1c échantillon A (%)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Roche, Cobas	15	100.0	0.0	0.0	6.0	3.3	e
2 HPLC	6	100.0	0.0	0.0	6.1	1.5	e
3 Afinion	555	99.1	0.2	0.7	5.9	2.4	e
4 Cobas b101	143	94.4	4.9	0.7	6.0	3.7	e
5 DCA2000/Vantage	148	93.9	2.0	4.1	6.2	3.3	e
6 Celltac chemi	21	100.0	0.0	0.0	5.7	3.0	e
7 NycoCard	16	93.7	6.3	0.0	6.2	5.8	e*
8 Eurolyser	10	90.0	10.0	0.0	6.0	4.4	e*
9 A1c Now	224	82.6	12.9	4.5	5.5	5.9	e
10 AFIAS	61	90.2	8.2	1.6	5.9	5.7	e
11 Andere	21	85.7	4.8	9.5	6.1	4.3	e
12 Spinit	11	90.9	0.0	9.1	6.3	2.3	e

## HbA1c échantillon B

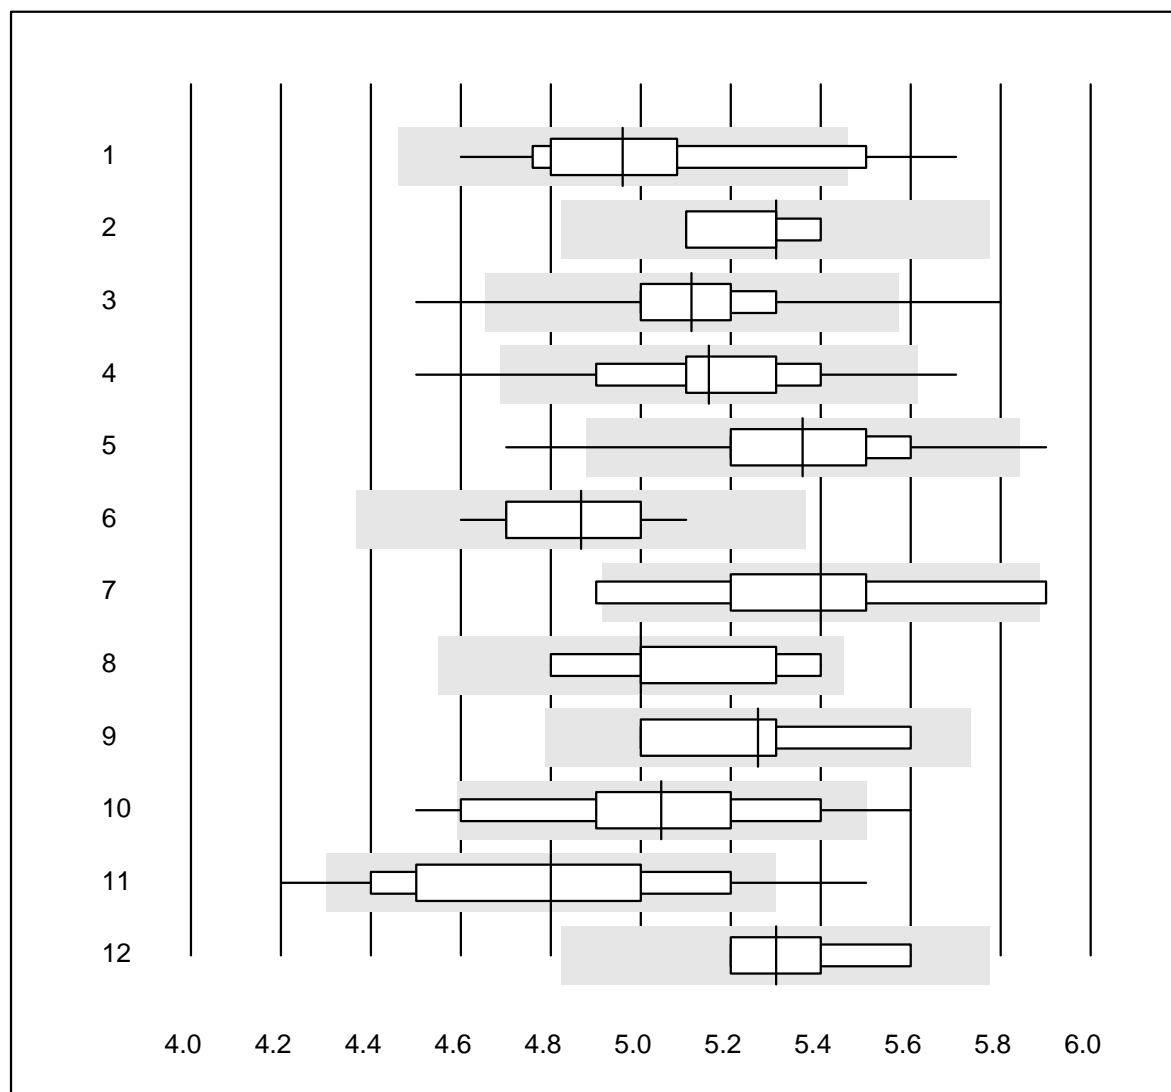


QUALAB Tolérance : 9 %  
( < 5.0: +/- 0.5 %)

HbA1c échantillon B (%)


No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	Roche, Cobas	14	85.7	14.3	0.0	5.0	6.0	e*
2	HPLC	7	100.0	0.0	0.0	5.3	2.2	e
3	Afinion	790	99.1	0.5	0.4	5.1	2.6	e
4	Cobas b101	165	97.0	2.4	0.6	5.2	3.8	e
5	DCA2000/Vantage	229	96.9	0.9	2.2	5.4	3.3	e
6	Celltac chemi	15	100.0	0.0	0.0	4.9	3.1	e
7	NycoCard	9	66.7	22.2	11.1	5.4	6.0	e*
8	Eurolyser	7	100.0	0.0	0.0	5.0	4.0	e*
9	Hemocue HbA1c 501	4	100.0	0.0	0.0	5.3	5.5	a
10	A1c Now	14	78.6	14.3	7.1	5.0	6.2	e*
11	AFIAS	90	90.0	8.9	1.1	4.8	6.5	e
12	Spinit	5	100.0	0.0	0.0	5.3	3.1	e*
13	Autre	18	94.4	5.6	0.0	5.2	4.5	e

## pCO2

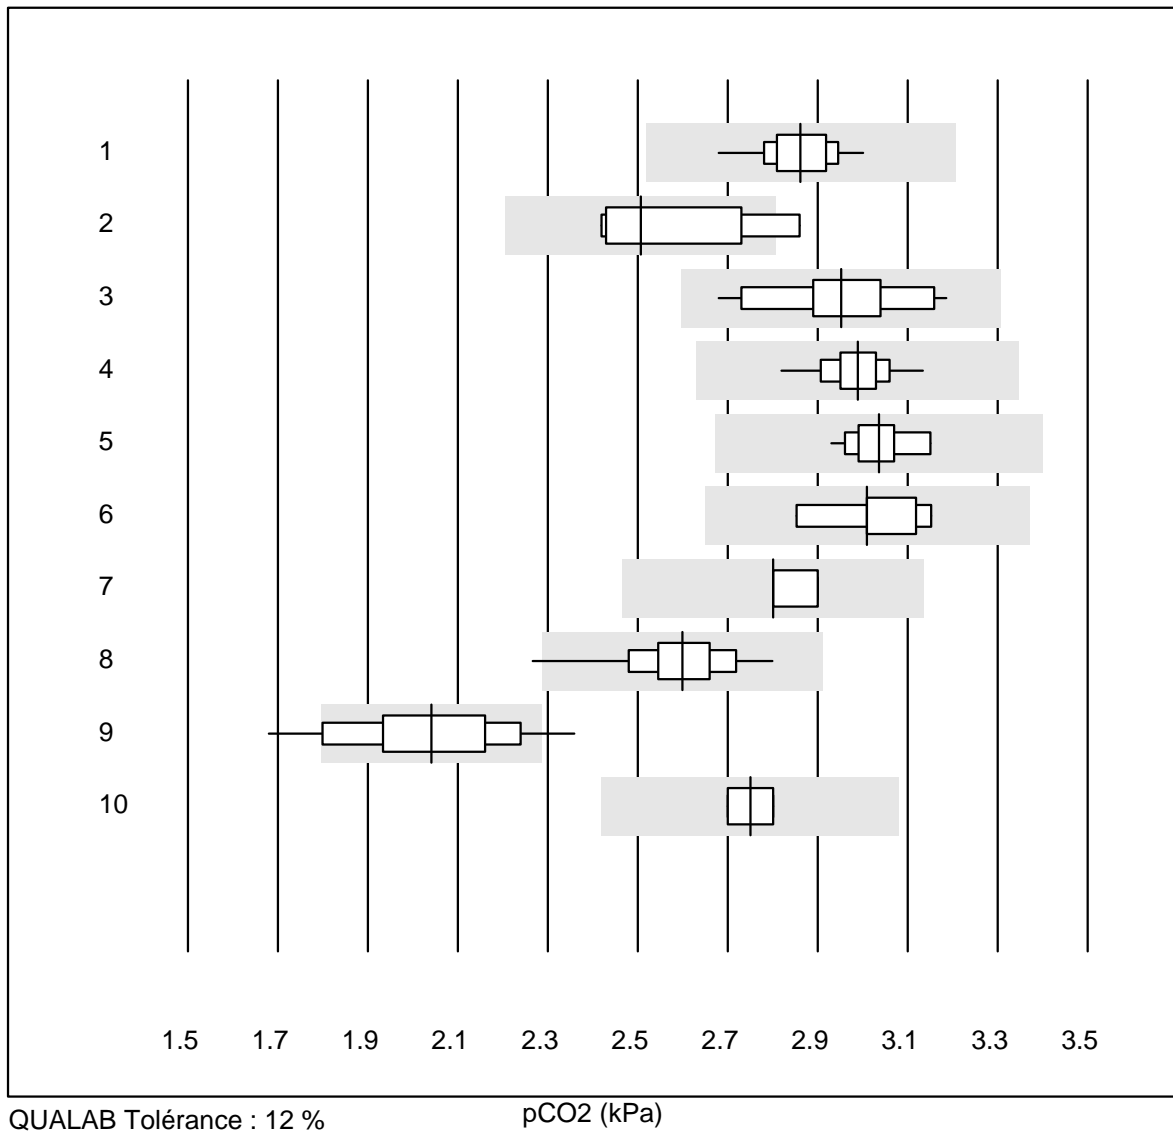


No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	ABL700/800	94	100.0	0.0	0.0	2.86	2.4	e
2	ABL80 FLEX	7	85.7	14.3	0.0	2.51	6.4	e*
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	14	92.9	0.0	7.1	2.95	5.4	e*
4	ABL90 FLEX / PLUS	82	100.0	0.0	0.0	2.99	2.0	e
5	Cobas b 123	15	100.0	0.0	0.0	3.04	2.3	e
6	Cobas b 221	7	85.7	0.0	14.3	3.01	3.5	e
7	GEM	7	100.0	0.0	0.0	2.80	1.7	e
8	iStat	39	94.8	2.6	2.6	2.60	4.0	e
9	EPOC	48	79.2	12.5	8.3	2.04	8.3	e
10	IL	4	100.0	0.0	0.0	2.75	2.1	e

pO2

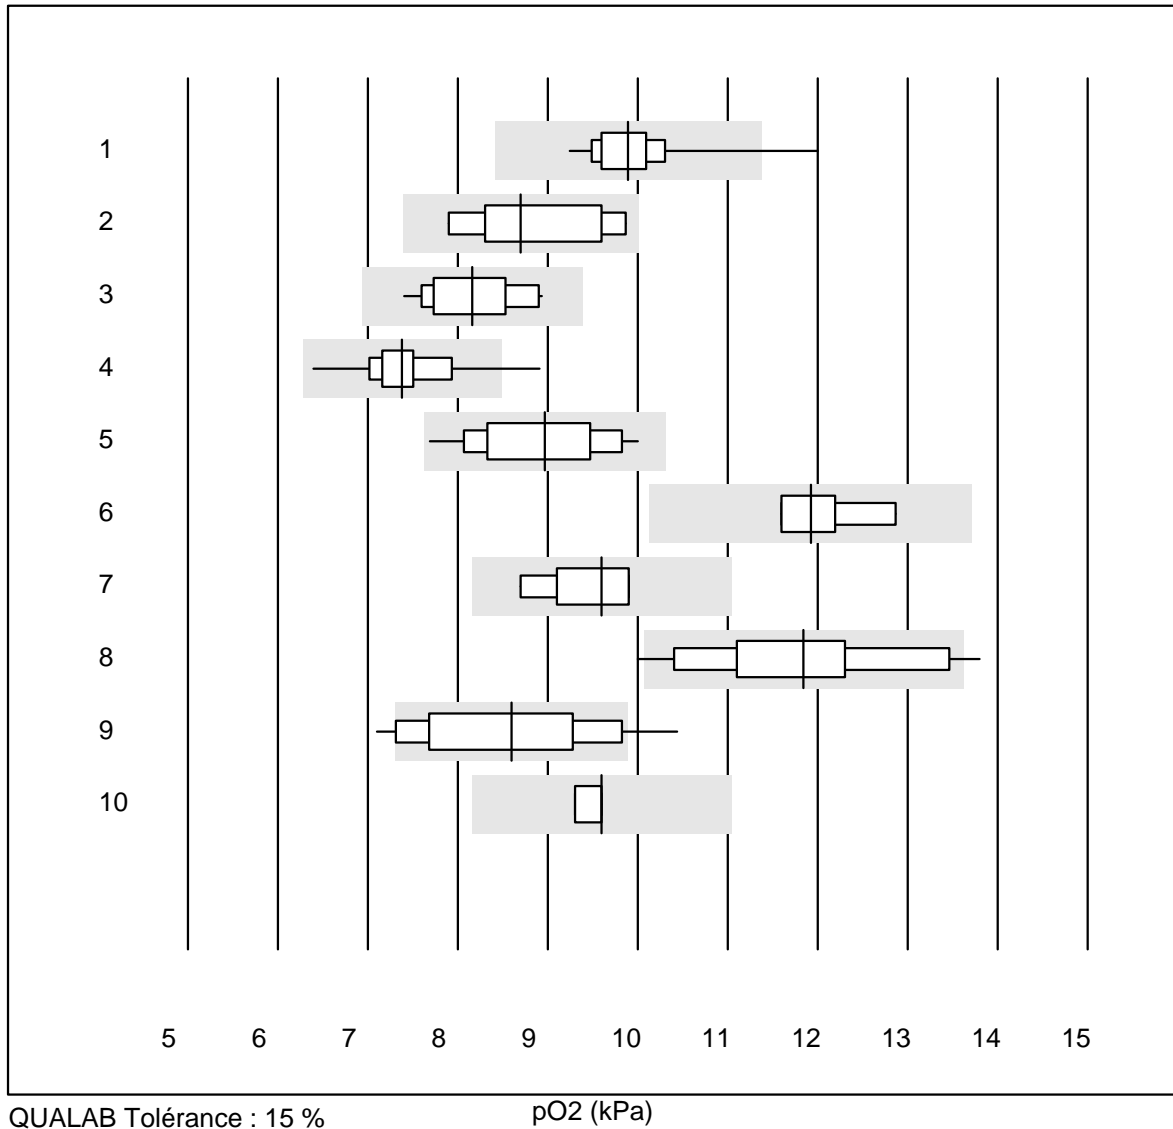

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 ABL700/800	93	95.6	2.2	2.2	9.89	4.7	e
2 ABL80 FLEX	7	100.0	0.0	0.0	8.70	8.2	e*
3 ABL80 FLEX CO-OX / O	14	85.7	0.0	14.3	8.16	6.2	e
4 ABL90 FLEX / PLUS	83	88.0	2.4	9.6	7.38	6.1	e
5 Cobas b 123	17	100.0	0.0	0.0	8.97	7.5	e*
6 Cobas b 221	4	100.0	0.0	0.0	11.92	4.9	e*
7 GEM	7	100.0	0.0	0.0	9.60	4.8	e*
8 iStat	36	88.9	11.1	0.0	11.84	8.5	e
9 EPOC	48	70.8	10.4	18.8	8.59	10.9	e
10 IL	4	100.0	0.0	0.0	9.60	1.6	e

# pH

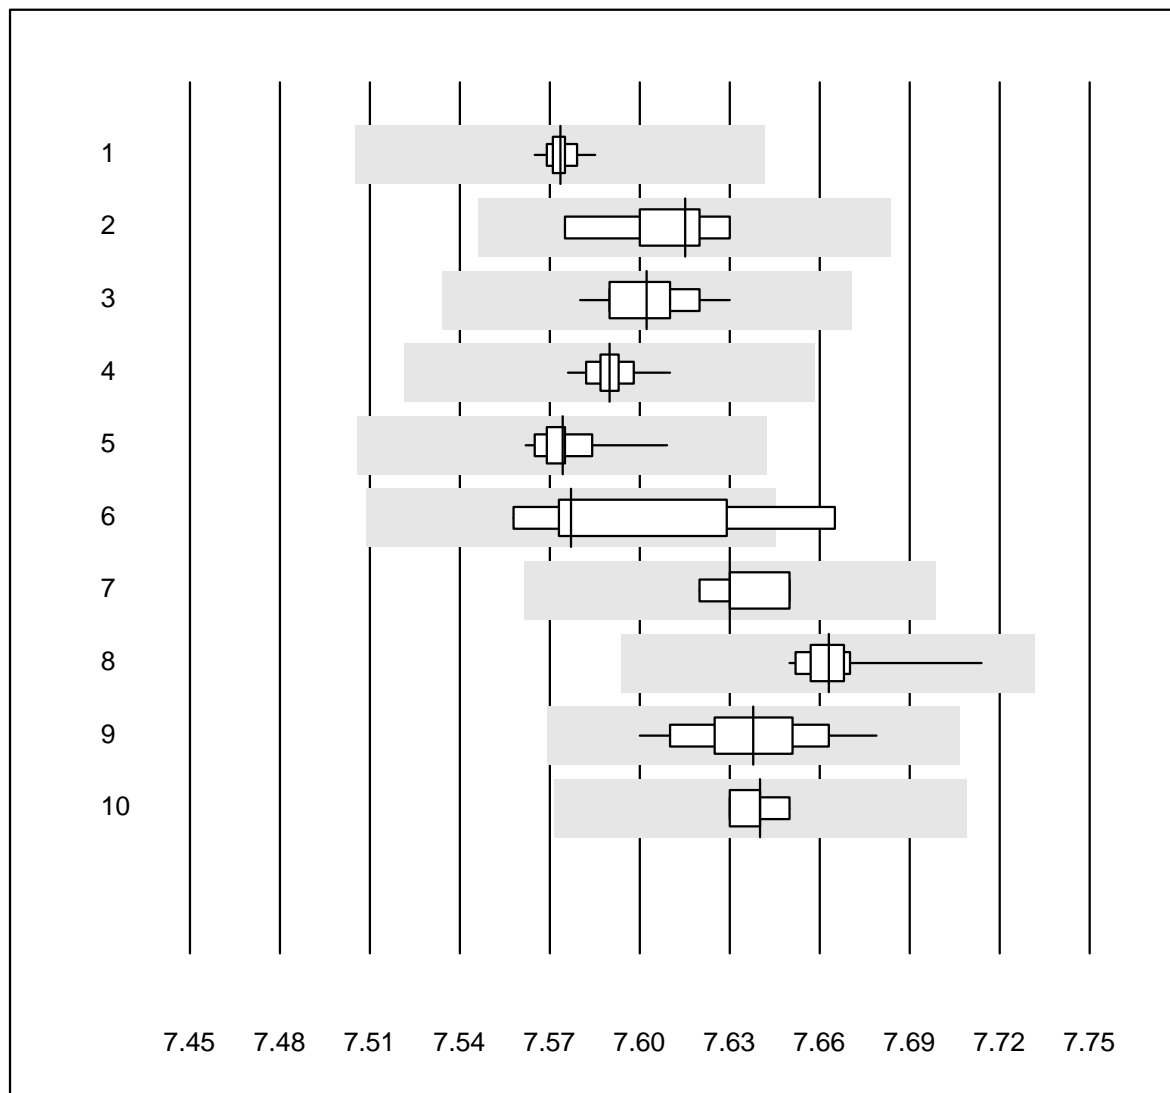


QUALAB Tolérance : 1 %

pH ()

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 ABL700/800	93	100.0	0.0	0.0	7.57	0.0	e
2 ABL80 FLEX	8	100.0	0.0	0.0	7.62	0.2	e
3 ABL80 FLEX CO-OX / O	13	100.0	0.0	0.0	7.60	0.2	e
4 ABL90 FLEX / PLUS	84	100.0	0.0	0.0	7.59	0.1	e
5 Cobas b 123	15	100.0	0.0	0.0	7.57	0.1	e
6 Cobas b 221	7	85.7	14.3	0.0	7.58	0.5	e*
7 GEM	7	100.0	0.0	0.0	7.63	0.1	e
8 iStat	40	97.5	0.0	2.5	7.66	0.1	e
9 EPOC	47	100.0	0.0	0.0	7.64	0.2	e
10 IL	4	100.0	0.0	0.0	7.64	0.1	e

## Glucose GS

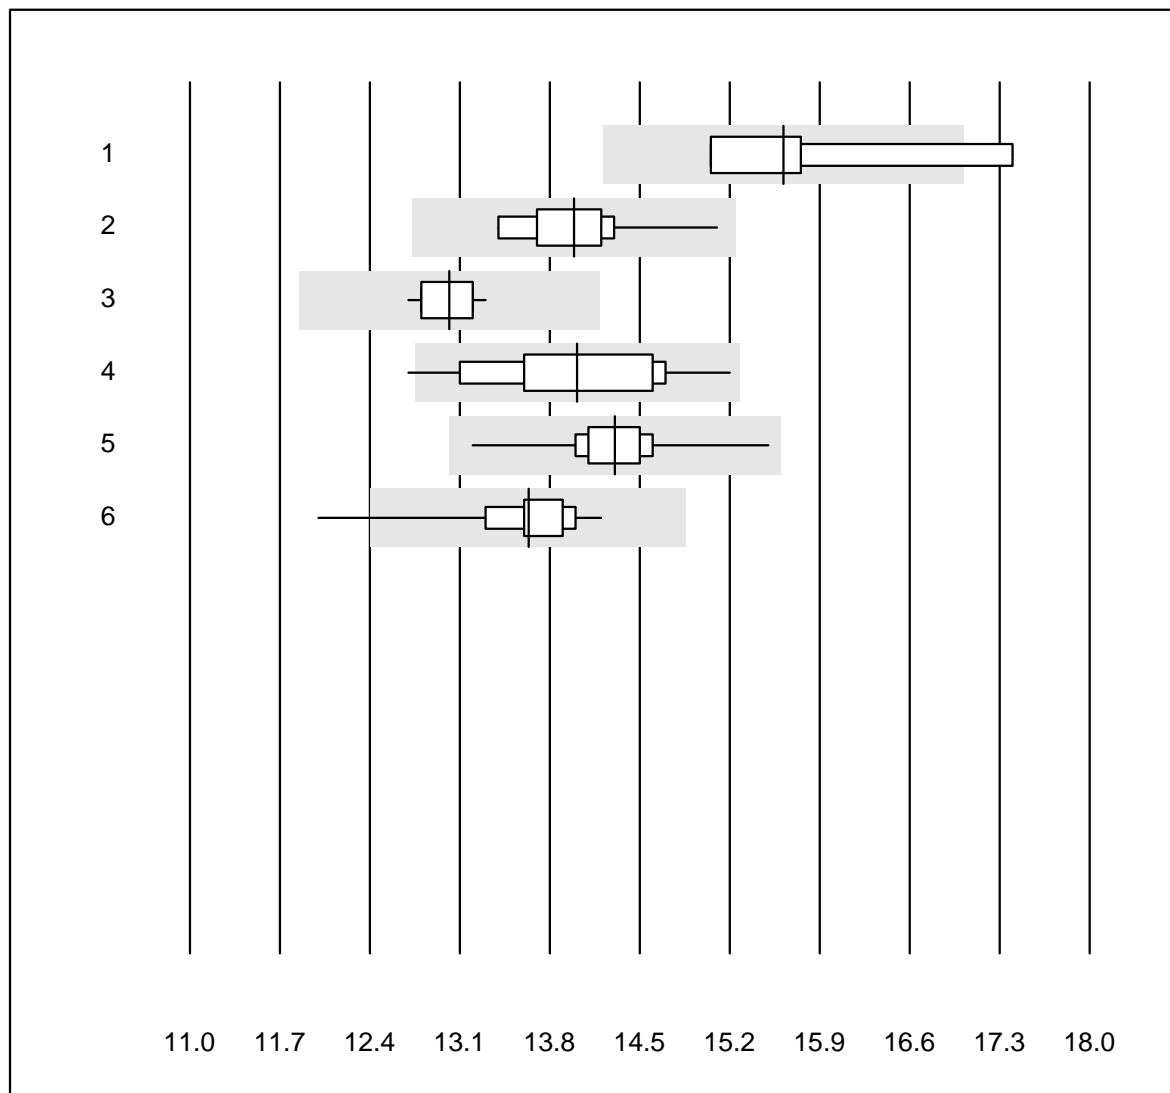


QUALAB Tolérance : 9 %

Glucose GS (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas b 221	4	75.0	25.0	0.0	15.6	6.5	e*
2 Cobas b 123	10	100.0	0.0	0.0	14.0	3.5	e*
3 iStat	11	100.0	0.0	0.0	13.0	1.7	e
4 EPOC	37	91.9	2.7	5.4	14.0	4.6	e
5 ABL700/800	85	98.8	0.0	1.2	14.3	2.3	e
6 ABL90 FLEX / PLUS	81	96.3	3.7	0.0	13.6	3.0	e



## Hémoglobine BG

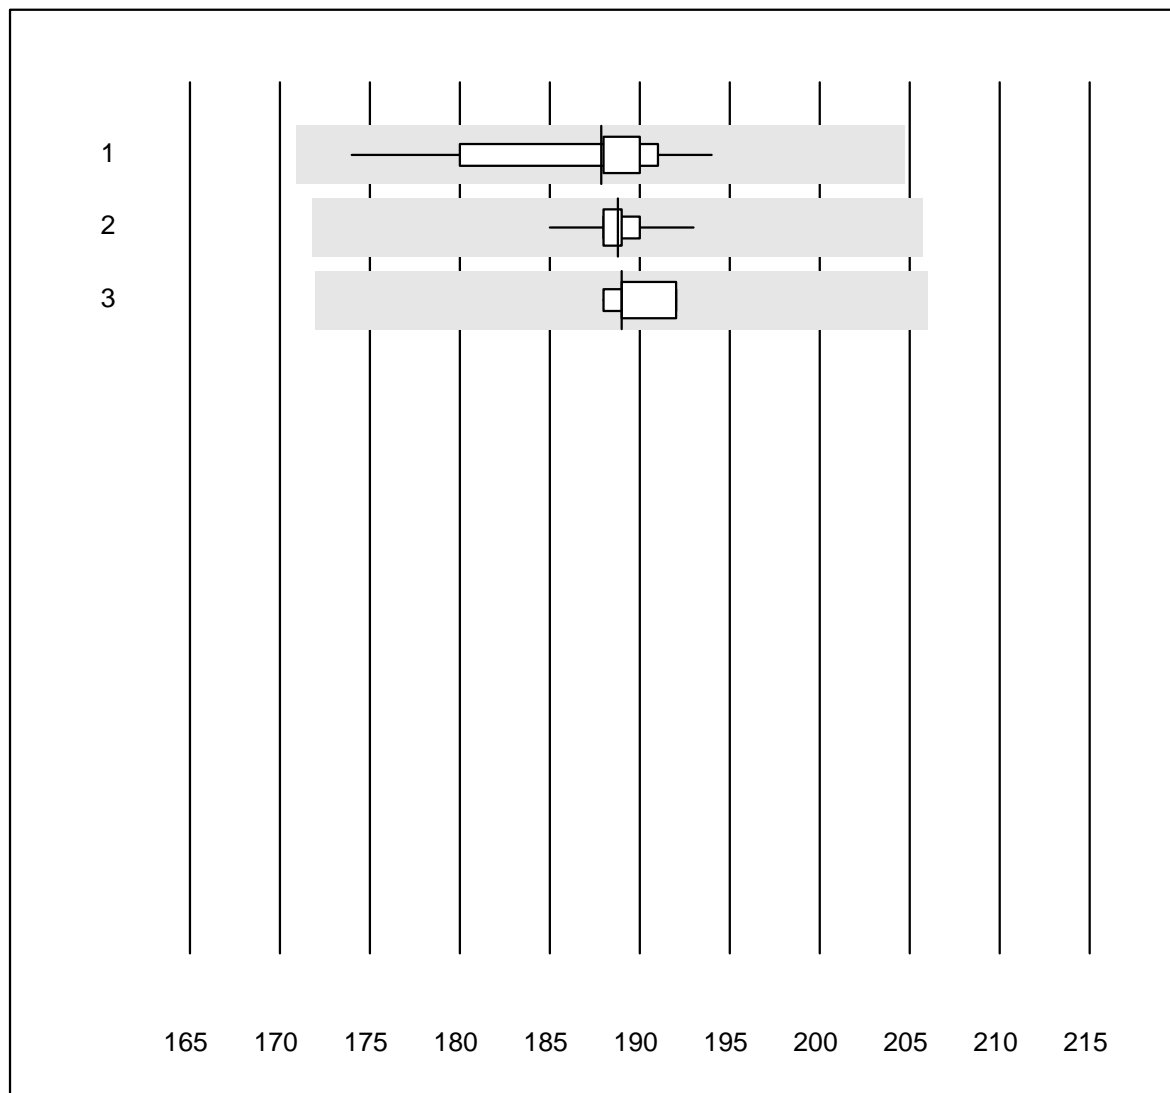


QUALAB Tolérance : 9 %

Hémoglobine BG (g/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 ABL700/800	86	100.0	0.0	0.0	187.8	2.3	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	77	96.1	0.0	3.9	188.8	0.6	e
3 ABL80 FLEX CO-OX / O	9	100.0	0.0	0.0	189.0	0.9	e

## Potassium BG

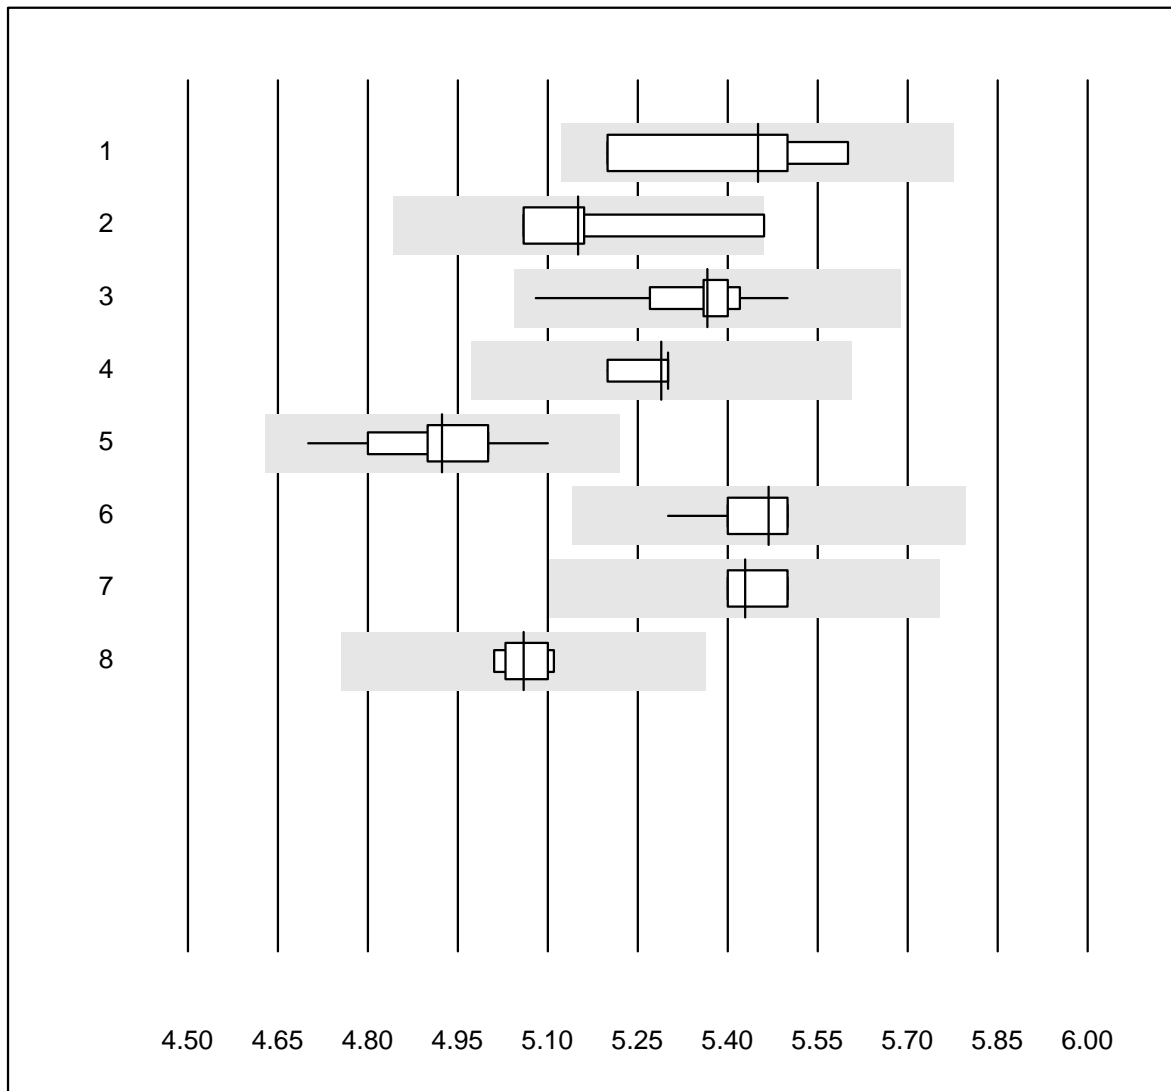


QUALAB Tolérance : 6 %

Potassium BG (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 GEM	4	100.0	0.0	0.0	5.5	3.1	e*
2 ABL80 FLEX	4	75.0	25.0	0.0	5.2	3.4	e*
3 Cobas b 123	20	100.0	0.0	0.0	5.4	1.5	e
4 iStat	19	100.0	0.0	0.0	5.3	0.6	e
5 EPOC	42	100.0	0.0	0.0	4.9	2.1	e
6 ABL700/800	86	100.0	0.0	0.0	5.5	0.9	e
7 ABL90 FLEX / PLUS	83	100.0	0.0	0.0	5.4	0.8	e
8 ABL80 FLEX CO-OX / O	5	100.0	0.0	0.0	5.1	0.9	e

## Sodium BG

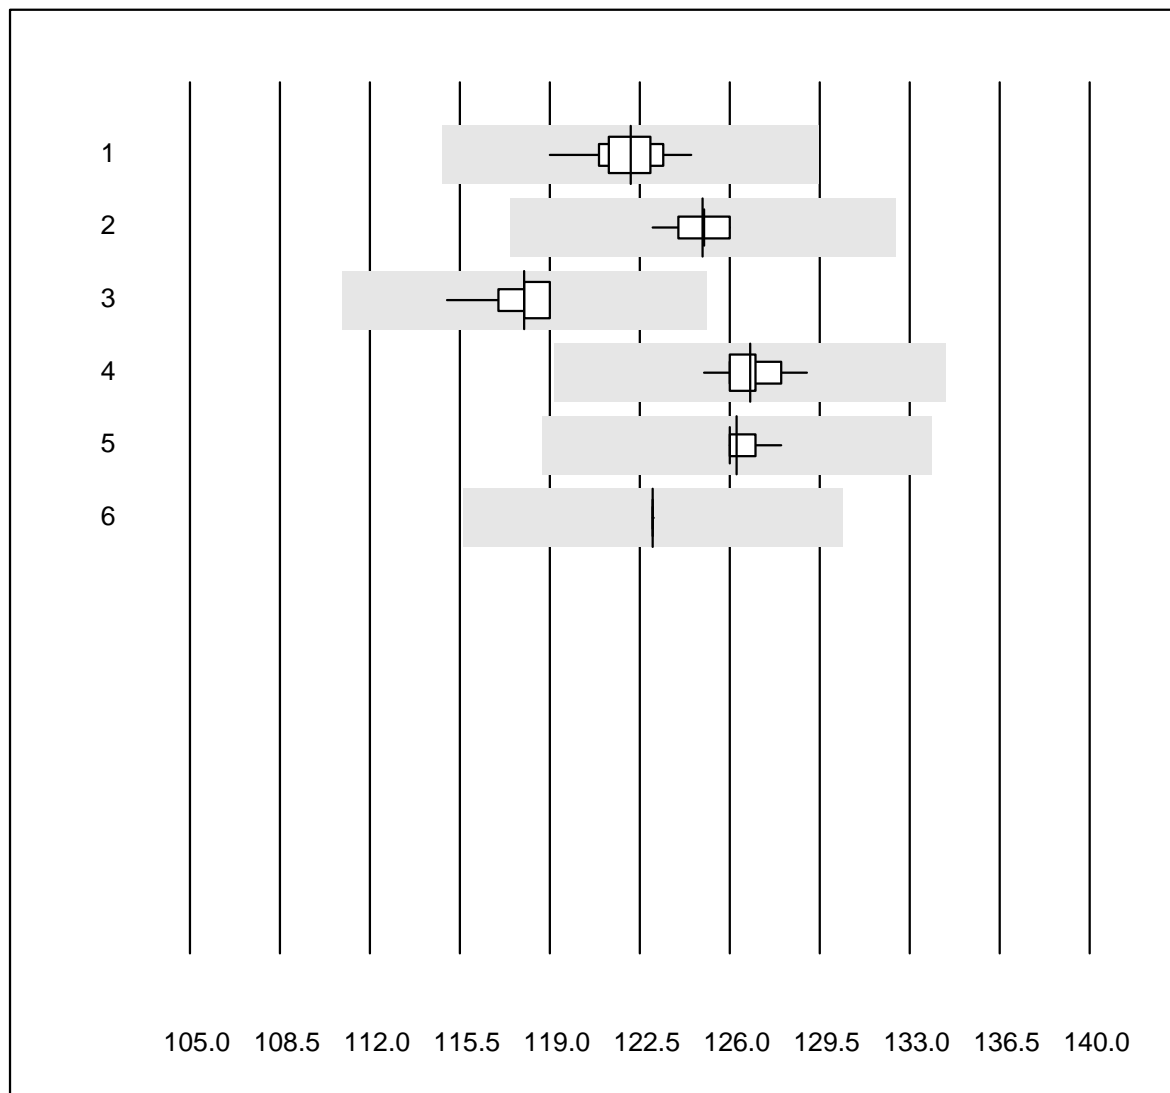


QUALAB Tolérance : 6 %

Sodium BG (mmol/l)


No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	Cobas b 123	20	100.0	0.0	0.0	122.2	1.0	e
2	iStat	19	100.0	0.0	0.0	124.9	0.6	e
3	EPOC	40	100.0	0.0	0.0	118.0	0.8	e
4	ABL700/800	84	100.0	0.0	0.0	126.8	0.8	e
5	ABL90 FLEX / PLUS	82	100.0	0.0	0.0	126.3	0.4	e
6	ABL80 FLEX CO-OX / O	5	100.0	0.0	0.0	123.0	0.0	e

## Chlorure-BG

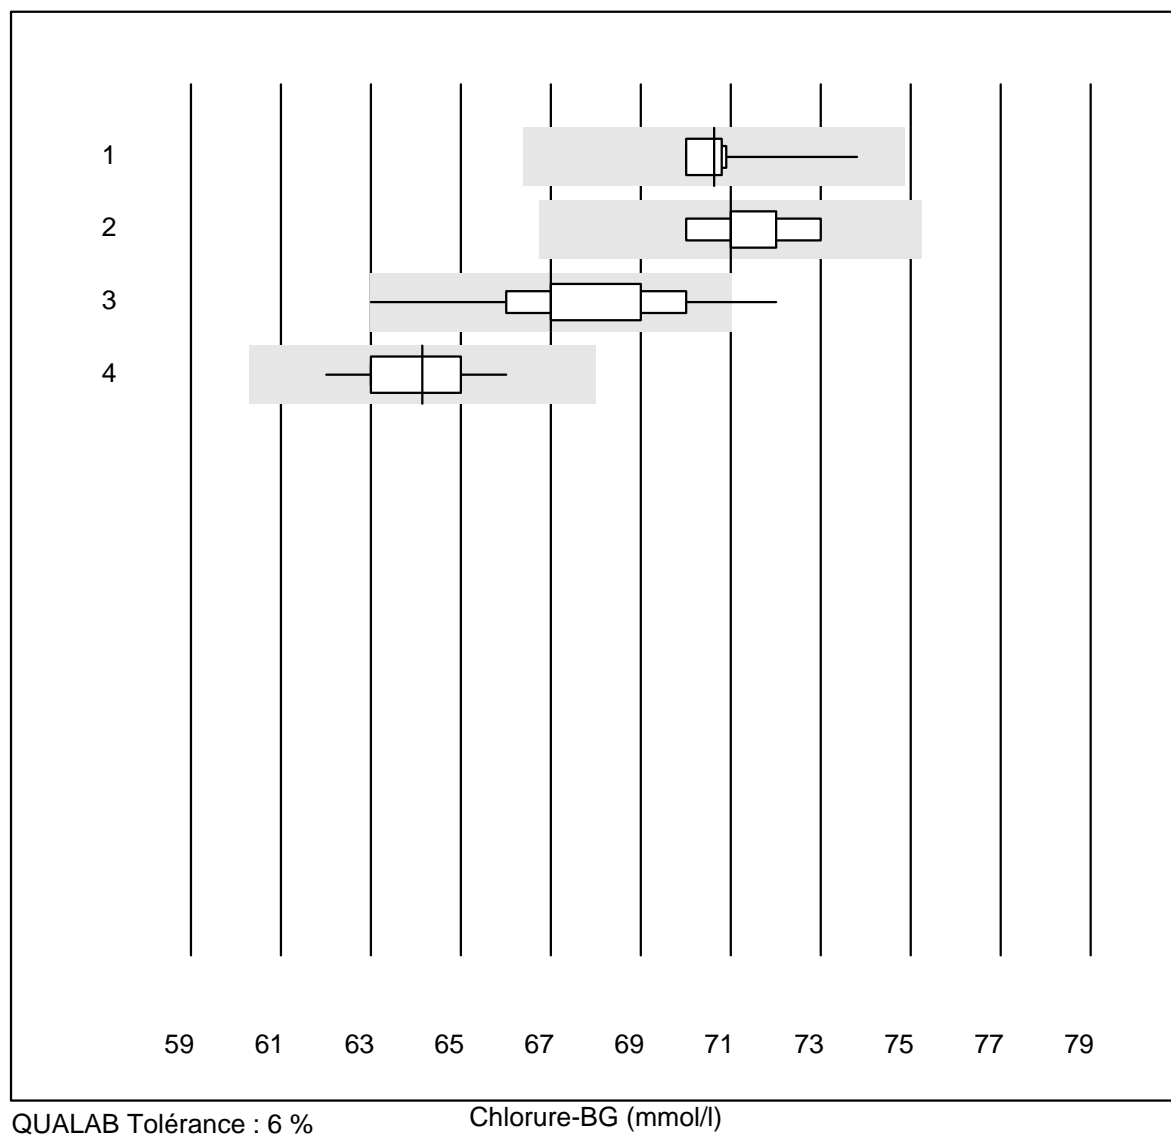

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas b 123	12	100.0	0.0	0.0	70.6	1.5	e
2 EPOC	9	100.0	0.0	0.0	71.0	1.4	e
3 ABL700/800	77	96.1	2.6	1.3	67.0	2.5	e
4 ABL90 FLEX / PLUS	77	100.0	0.0	0.0	64.1	1.5	e

## Calcium-BG

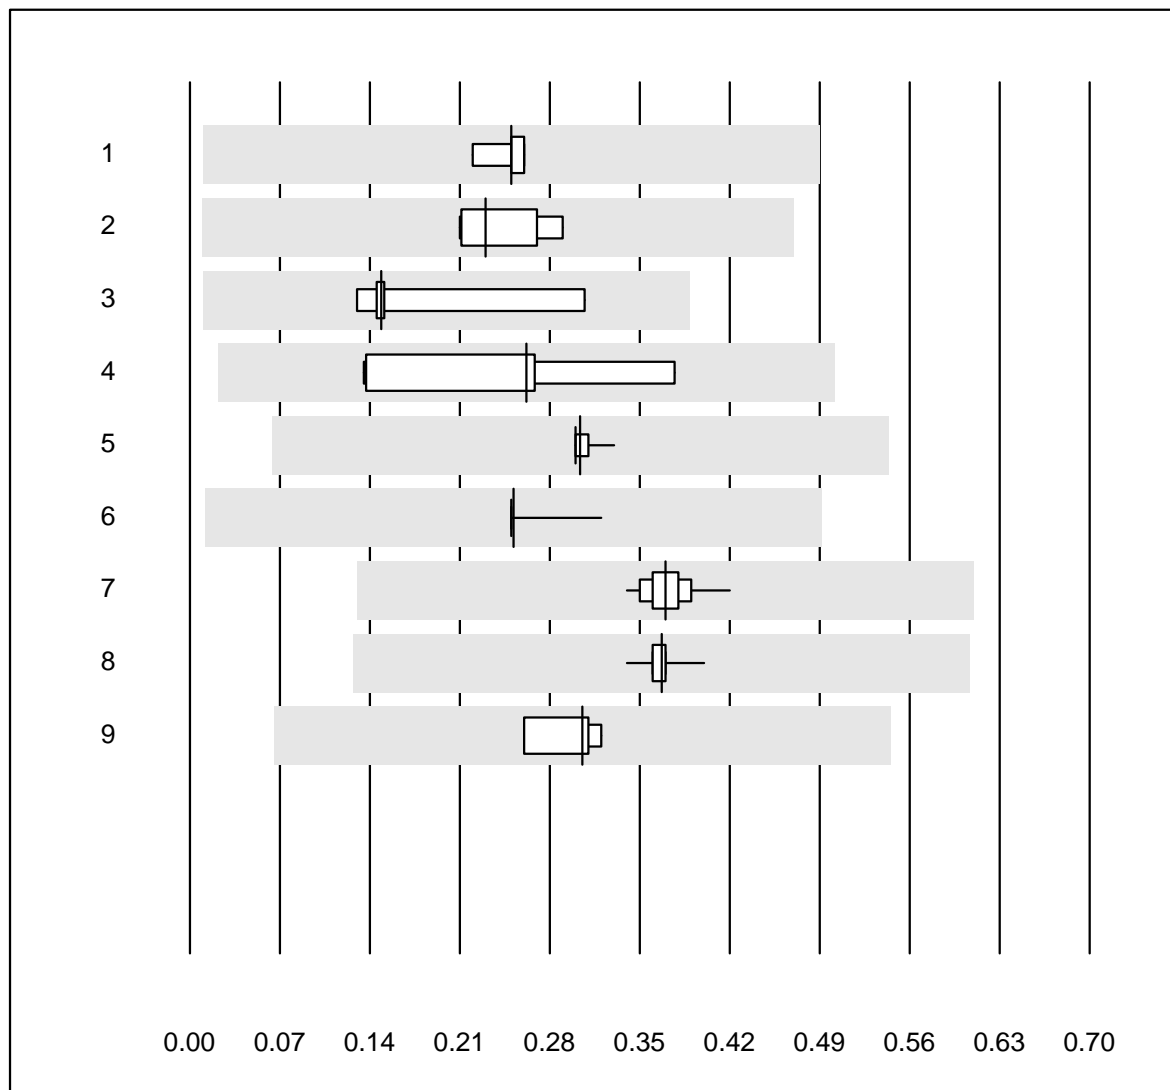


Tolérance MQ : 12 %  
( < 2.00: +/- 0.24 mmol/l)

Calcium-BG (mmol/l)


No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	GEM	5	100.0	0.0	0.0	0.25	6.6	e*
2	ABL80 FLEX	5	100.0	0.0	0.0	0.23	14.9	e*
3	Cobas b123	9	100.0	0.0	0.0	0.15	32.9	e*
4	Cobas	8	100.0	0.0	0.0	0.26	37.4	e*
5	iStat	12	100.0	0.0	0.0	0.30	2.9	e
6	EPOC	37	100.0	0.0	0.0	0.25	4.6	e
7	ABL700/800	86	100.0	0.0	0.0	0.37	4.4	e
8	ABL90 FLEX / PLUS	81	100.0	0.0	0.0	0.37	1.9	e
9	ABL80 FLEX CO-OX / O	4	100.0	0.0	0.0	0.31	8.8	e*

## FHHb

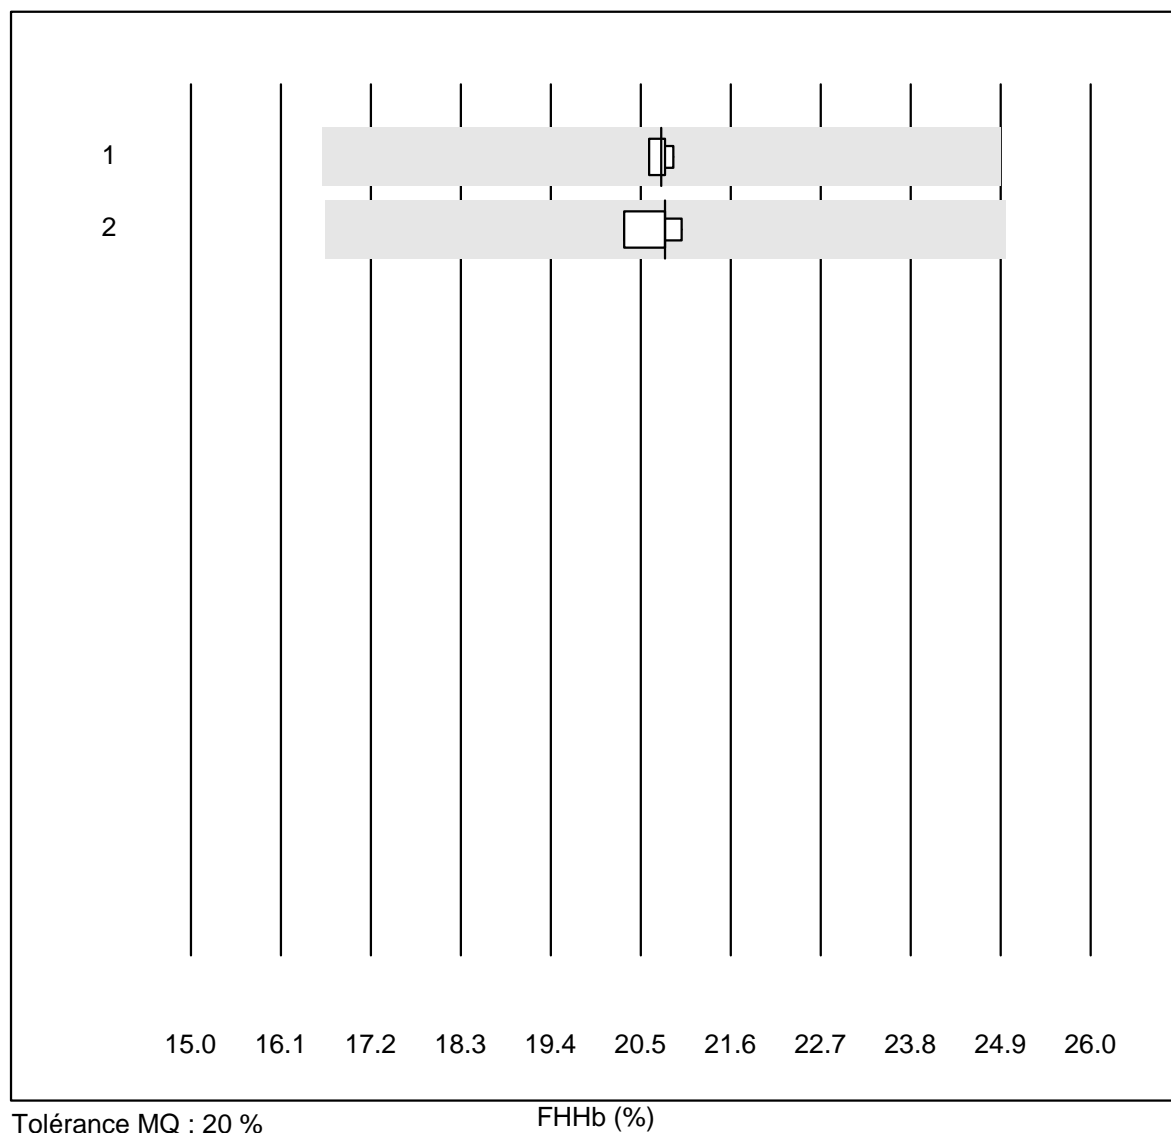


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 ABL90 FLEX / PLUS	4	100.0	0.0	0.0	20.750	0.6	e
2 ABL80 FLEX CO-OX / O	4	100.0	0.0	0.0	20.800	1.4	e

## Lactate-BG

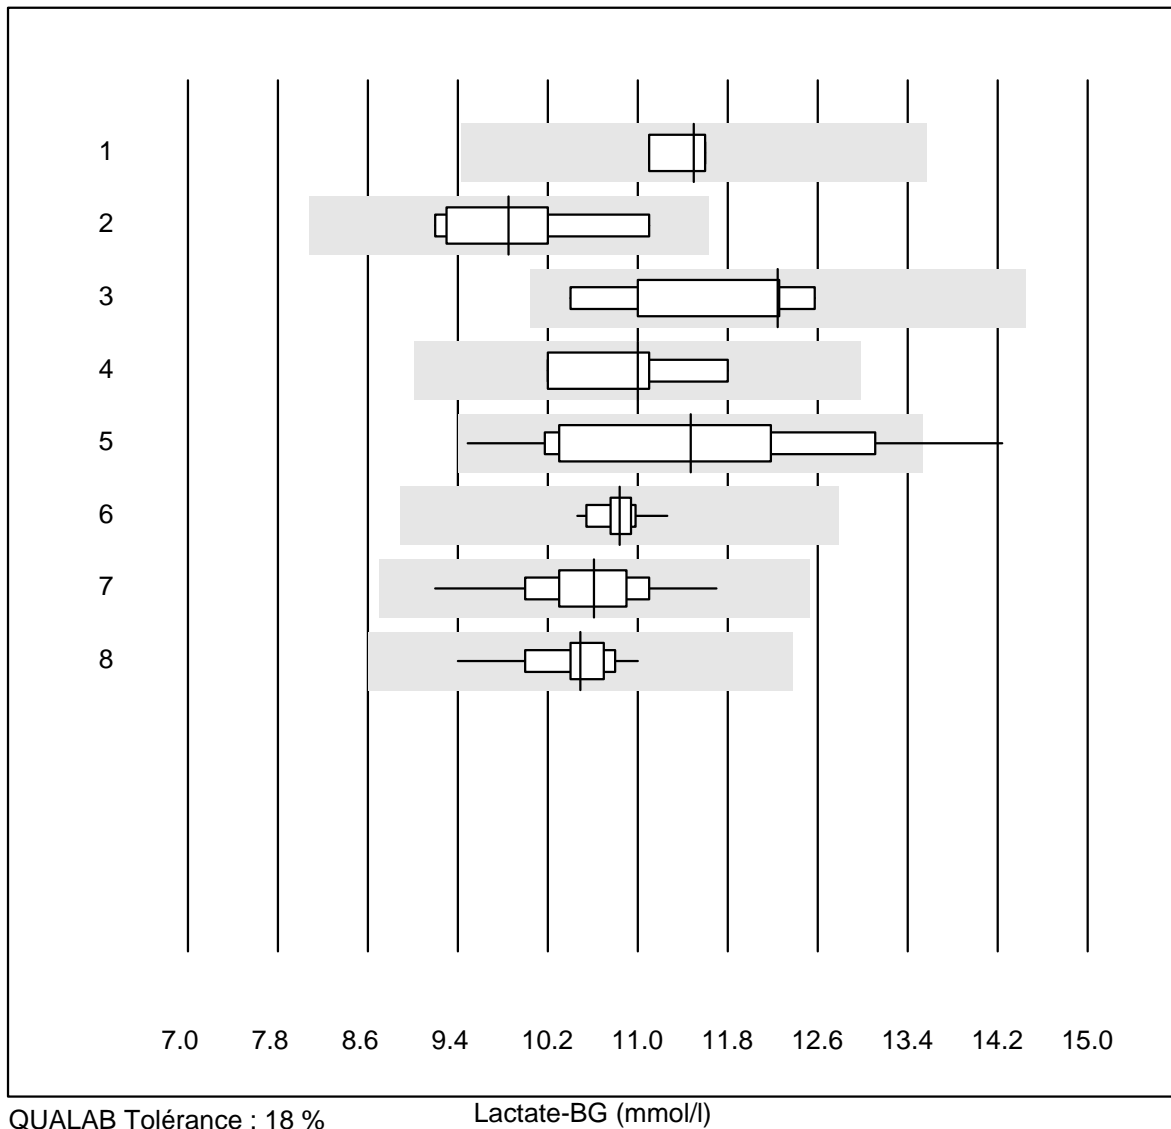

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 GEM	4	100.0	0.0	0.0	11.50	2.1	e
2 Cobas b123	8	100.0	0.0	0.0	9.85	6.1	e
3 Cobas	6	83.3	0.0	16.7	12.25	8.0	e*
4 IL	4	100.0	0.0	0.0	11.00	6.0	e*
5 EPOC	37	91.9	5.4	2.7	11.47	10.7	e
6 iStat	14	100.0	0.0	0.0	10.84	1.8	e
7 ABL700/800	88	100.0	0.0	0.0	10.61	4.4	e
8 ABL90 FLEX / PLUS	82	100.0	0.0	0.0	10.49	3.3	e

## sO2 OR

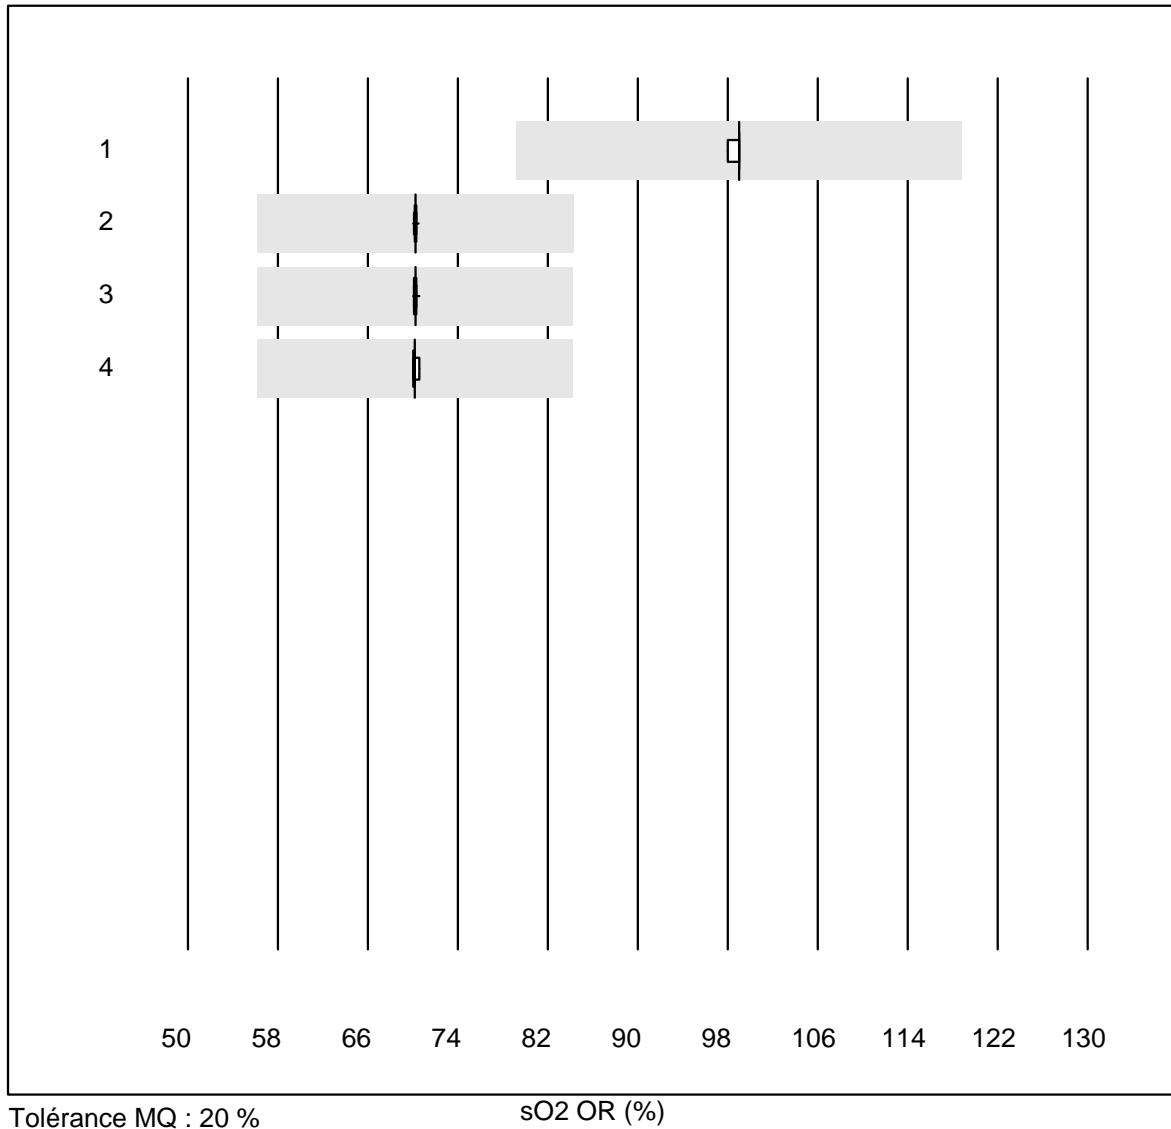


Tolérance MQ : 20 %

sO2 OR (%)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 iStat	9	100.0	0.0	0.0	99.000	0.4	e
2 ABL700/800	76	97.4	0.0	2.6	70.222	0.1	e
3 ABL90 FLEX / PLUS	73	98.6	0.0	1.4	70.207	0.1	e
4 ABL80 FLEX CO-OX / O	9	88.9	0.0	11.1	70.200	0.3	e



## FO2Hb OR

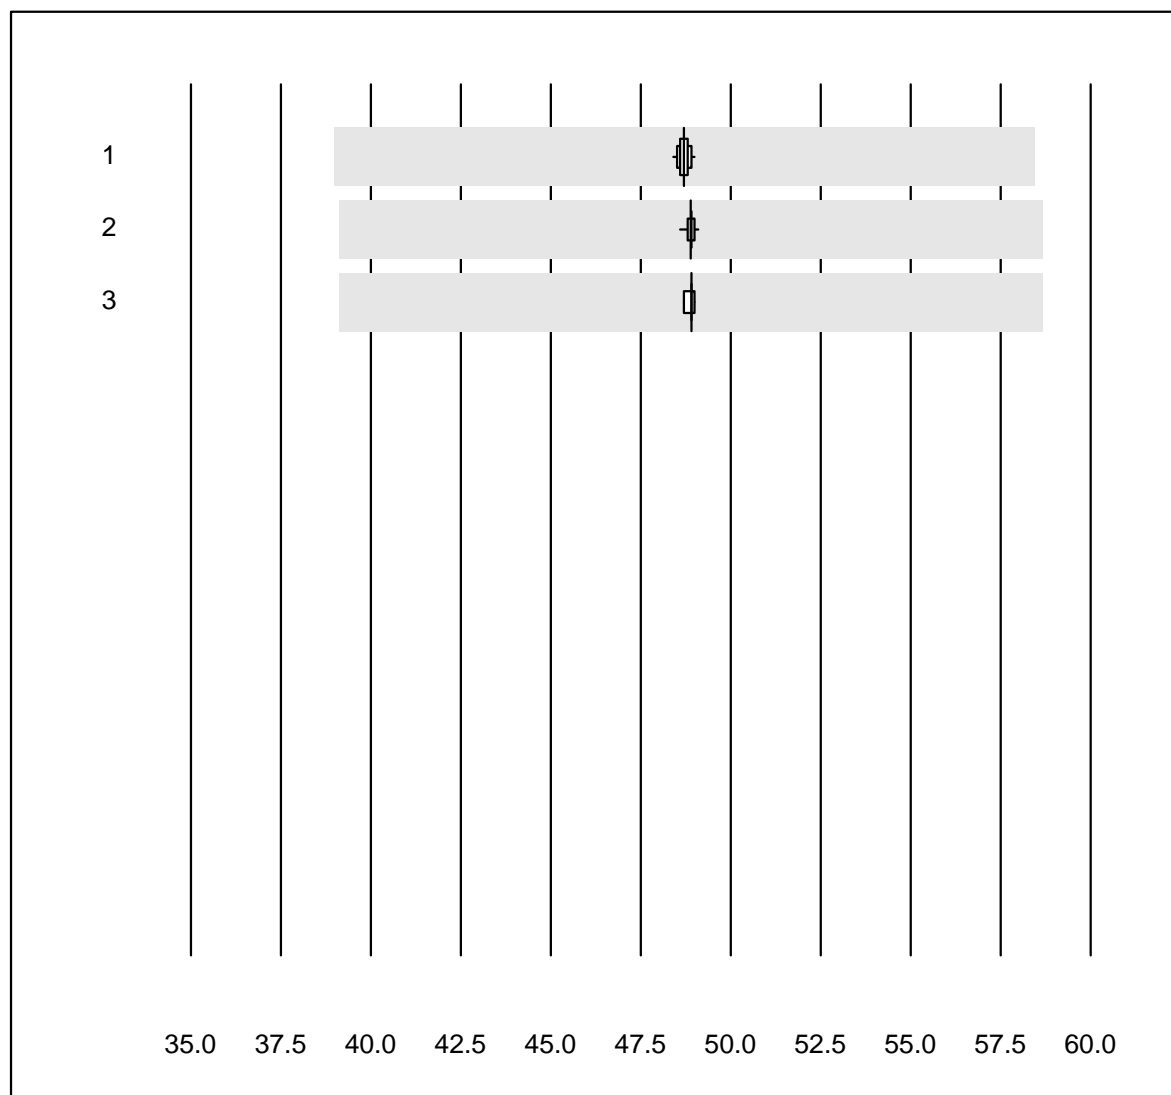


Tolérance MQ : 20 %

FO2Hb OR (%)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 ABL700/800	75	97.3	0.0	2.7	48.701	0.3	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	72	100.0	0.0	0.0	48.892	0.2	e
3 ABL80 FLEX CO-OX / O	10	100.0	0.0	0.0	48.900	0.2	e

## FCOHb OR

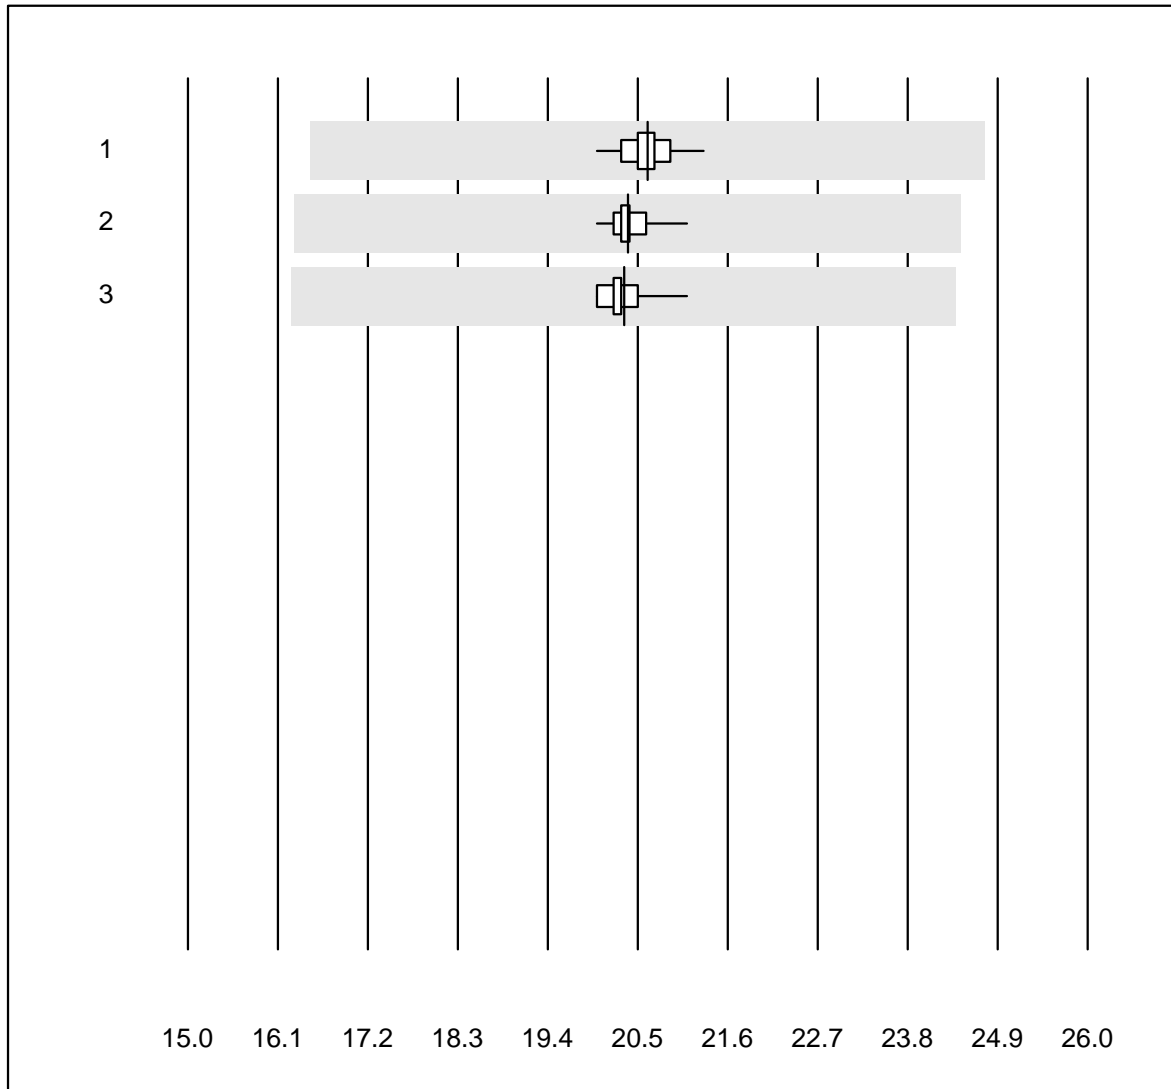


Tolérance MQ : 20 %

FCOHb OR (%)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 ABL700/800	77	97.4	0.0	2.6	20.623	1.1	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	71	100.0	0.0	0.0	20.378	0.8	e
3 ABL80 FLEX CO-OX / O	10	100.0	0.0	0.0	20.330	1.5	e

## FMetHb OR

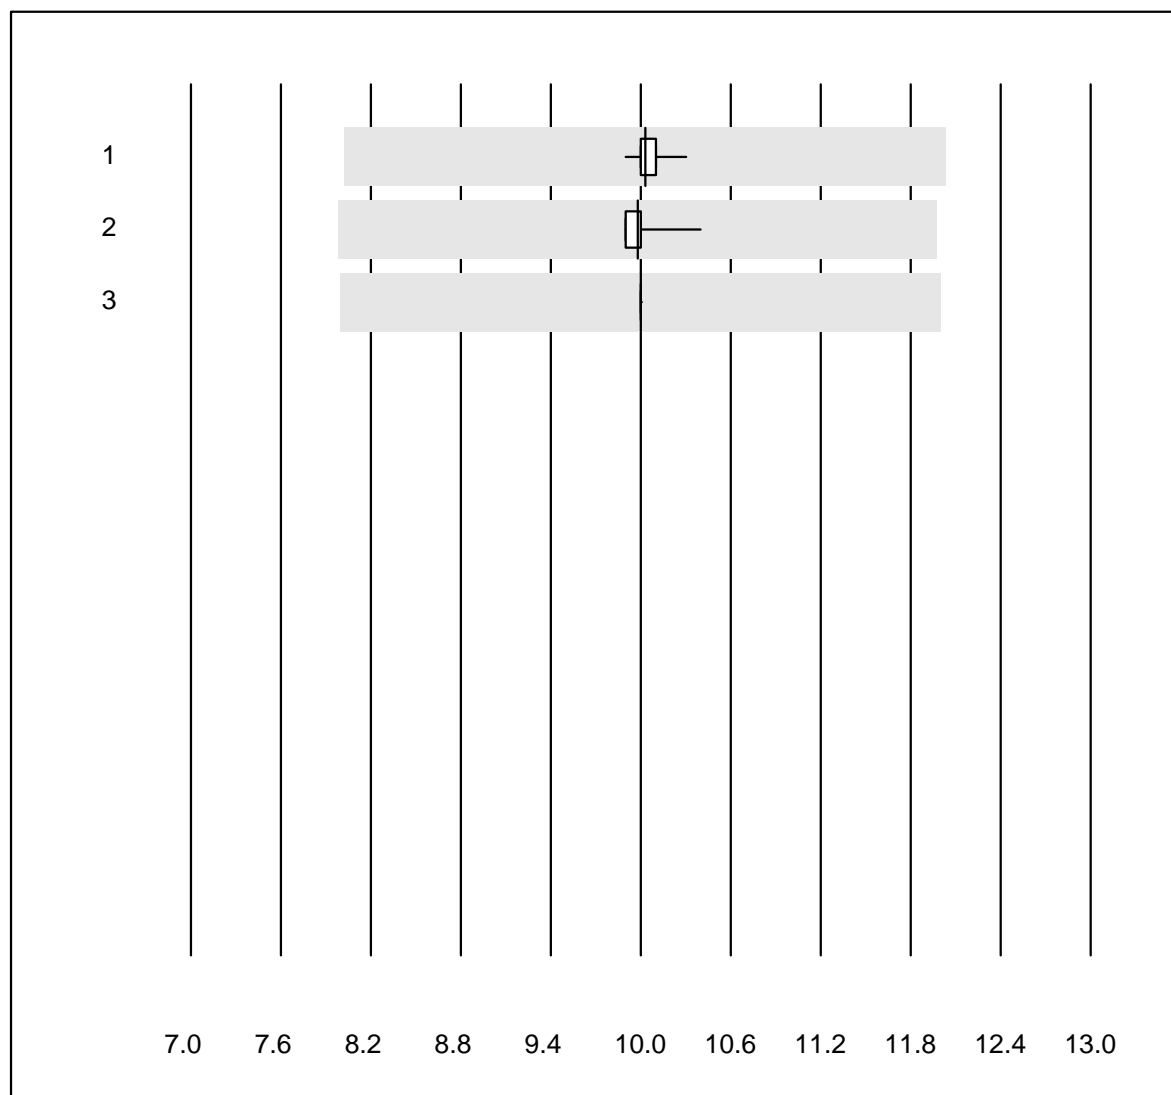


Tolérance MQ : 20 %

FMetHb OR (%)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 ABL700/800	77	97.4	0.0	2.6	10.031	0.8	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	71	100.0	0.0	0.0	9.979	0.7	e
3 ABL80 FLEX CO-OX / O	10	100.0	0.0	0.0	10.000	0.0	e

## FHbF OR

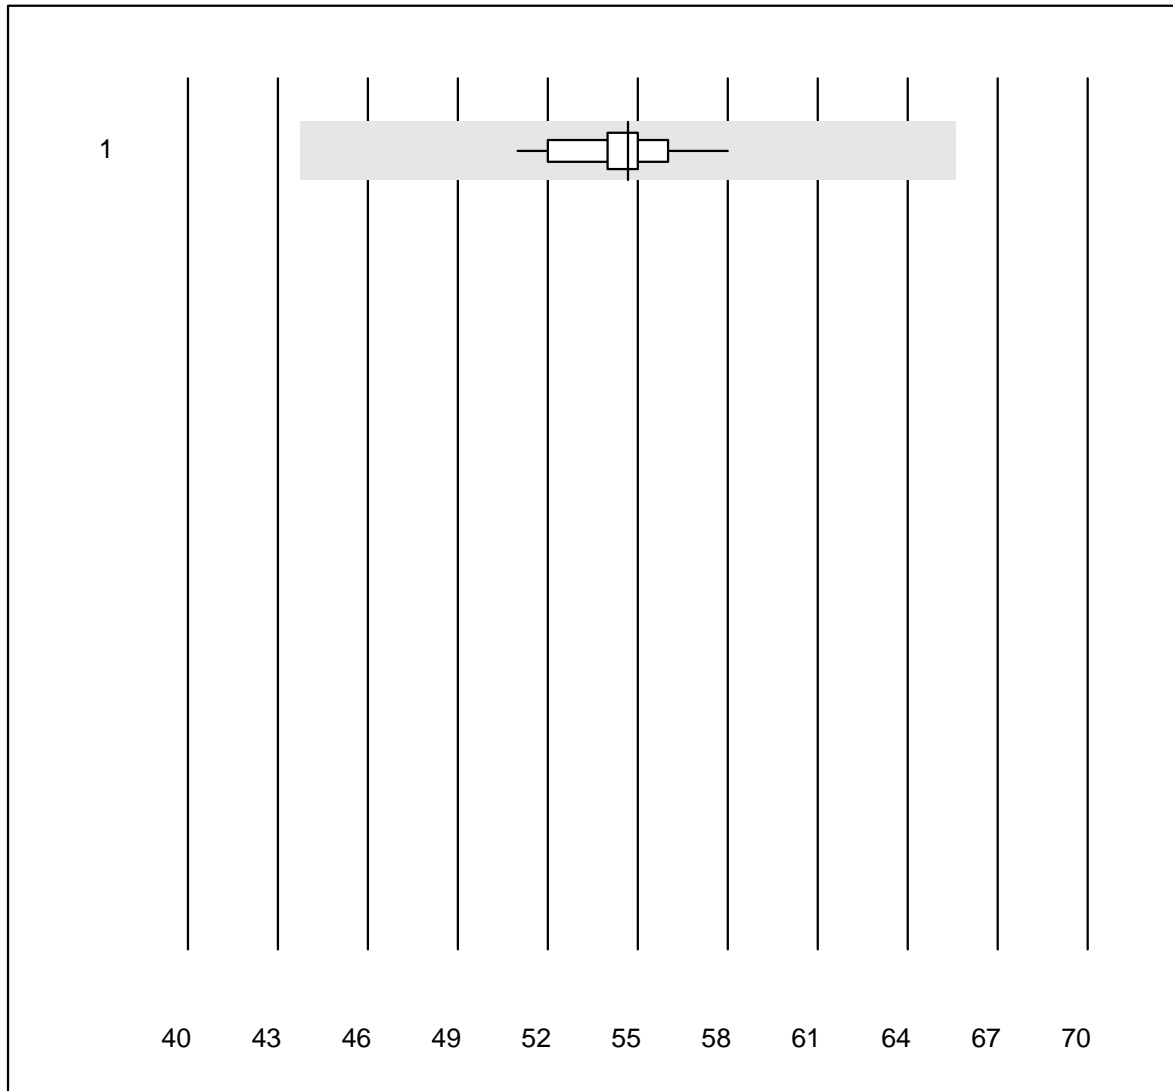


Tolérance MQ : 20 %

FHbF OR (%)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 ABL90 FLEX / PLUS	25	100.0	0.0	0.0	54.680	2.8	e

## Bilirubin OR

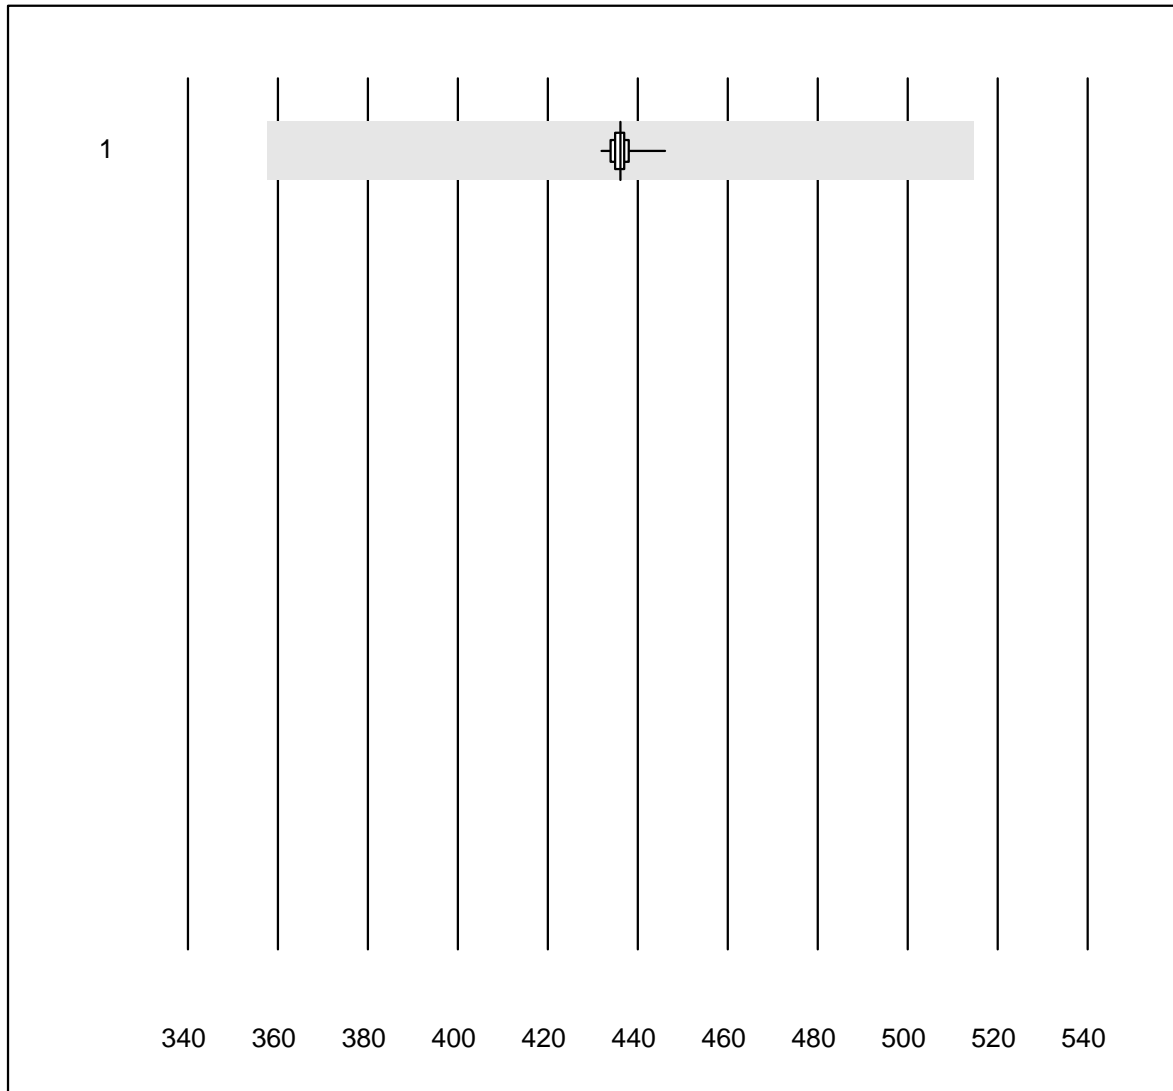


QUALAB Tolérance : 18 %

Bilirubin OR (µmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 ABL90 FLEX / PLUS	31	100.0	0.0	0.0	436.2	0.6	e

## Troponine I

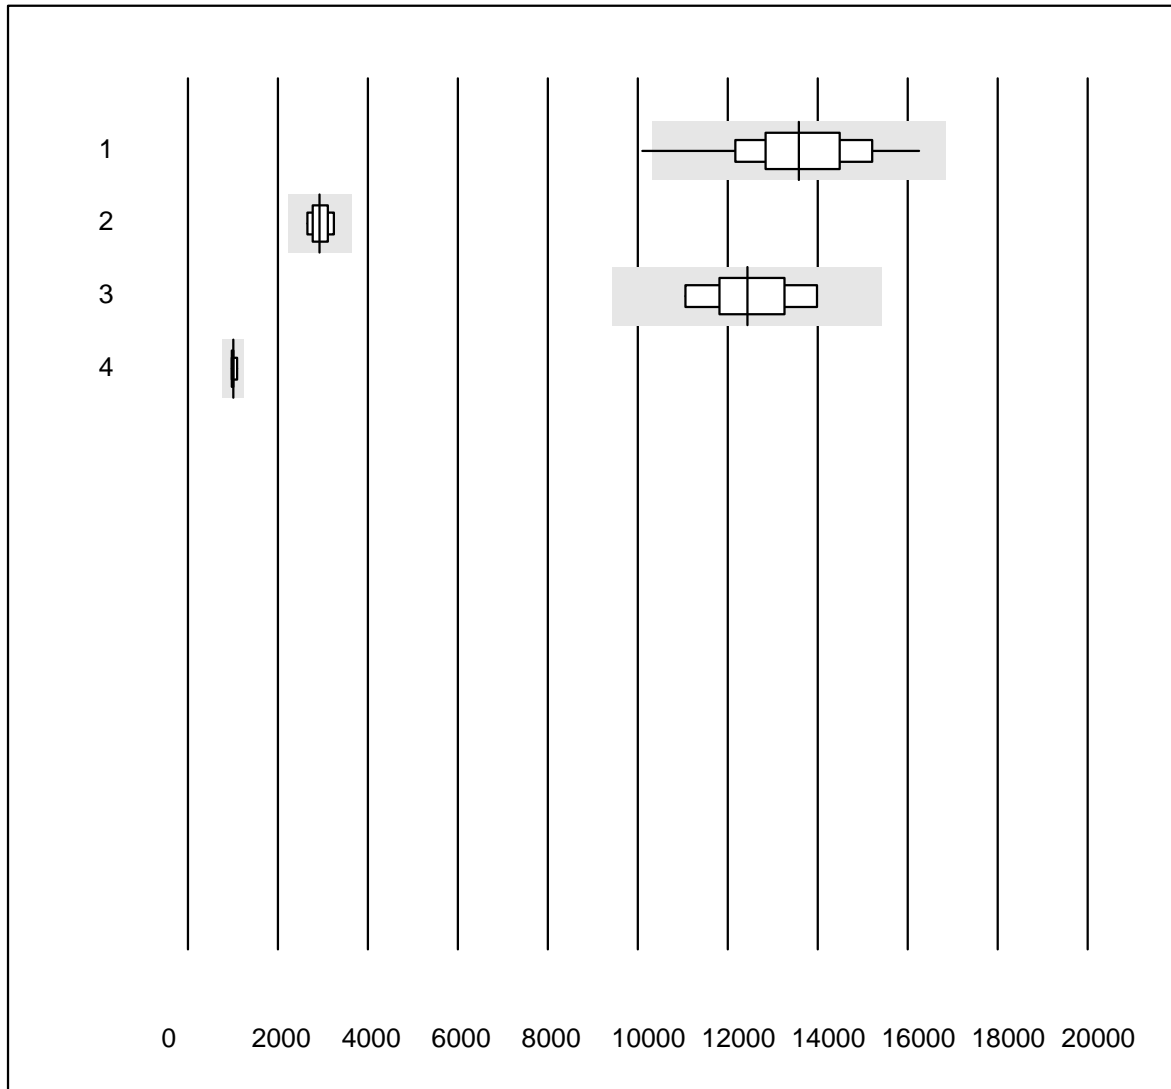


QUALAB Tolérance : 24 %

Troponine I (ng/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Vidas	11	90.9	9.1	0.0	13584.3	12.0	e*
2 Architect High Sensi	9	100.0	0.0	0.0	2921.0	6.8	e
3 Autres méthodes	7	100.0	0.0	0.0	12438.0	7.9	e*
4 AQT 90 FLEX	5	100.0	0.0	0.0	1000.0	5.0	e

## Troponine T

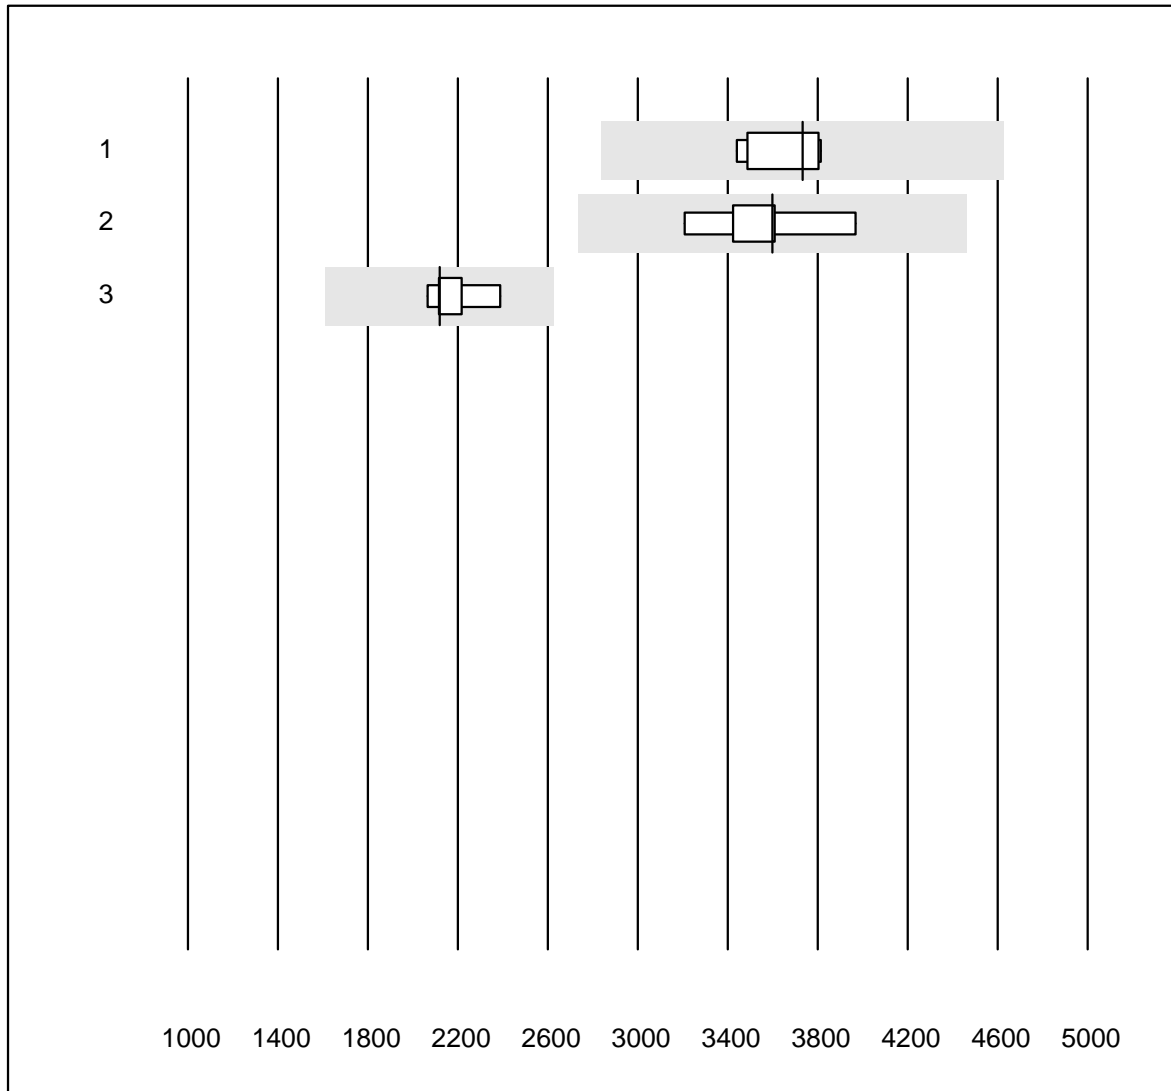


QUALAB Tolérance : 24 %

Troponine T (ng/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas hs	7	100.0	0.0	0.0	3732.00	4.4	e
2 Cobas hs STAT	8	100.0	0.0	0.0	3598.00	6.2	e
3 Cobas E / Elecsys	5	100.0	0.0	0.0	2119.00	5.9	e

# Myoglobine

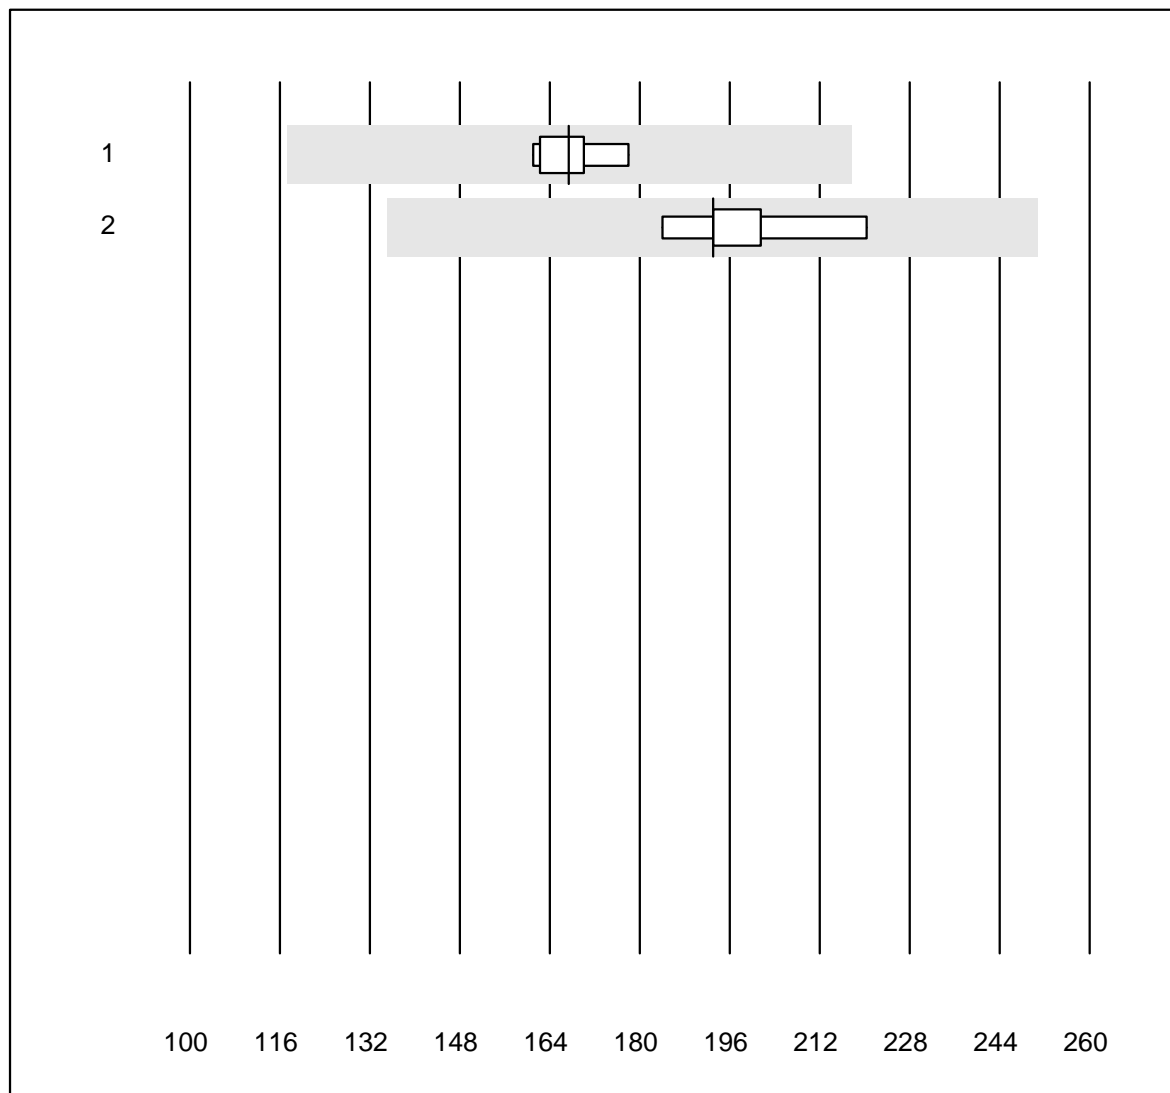


QUALAB Tolérance : 30 %

Myoglobine (µg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	6	100.0	0.0	0.0	167.4	3.7	e
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	193.0	6.9	e



## masse CK-MB

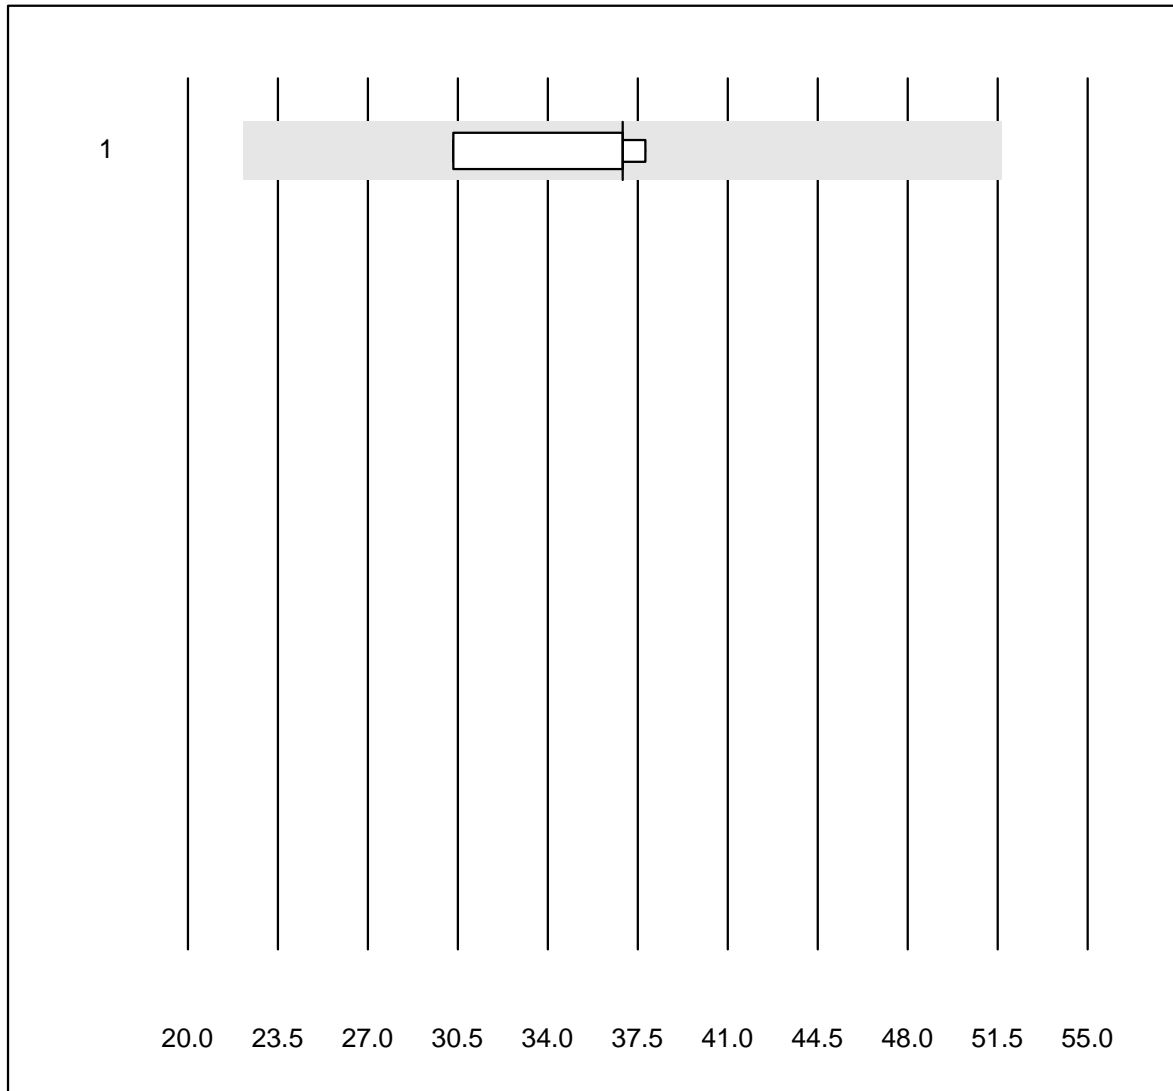


Tolérance MQ : 40 %

masse CK-MB (µg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	4	100.0	0.0	0.0	36.9	11.1	e*

# BNP

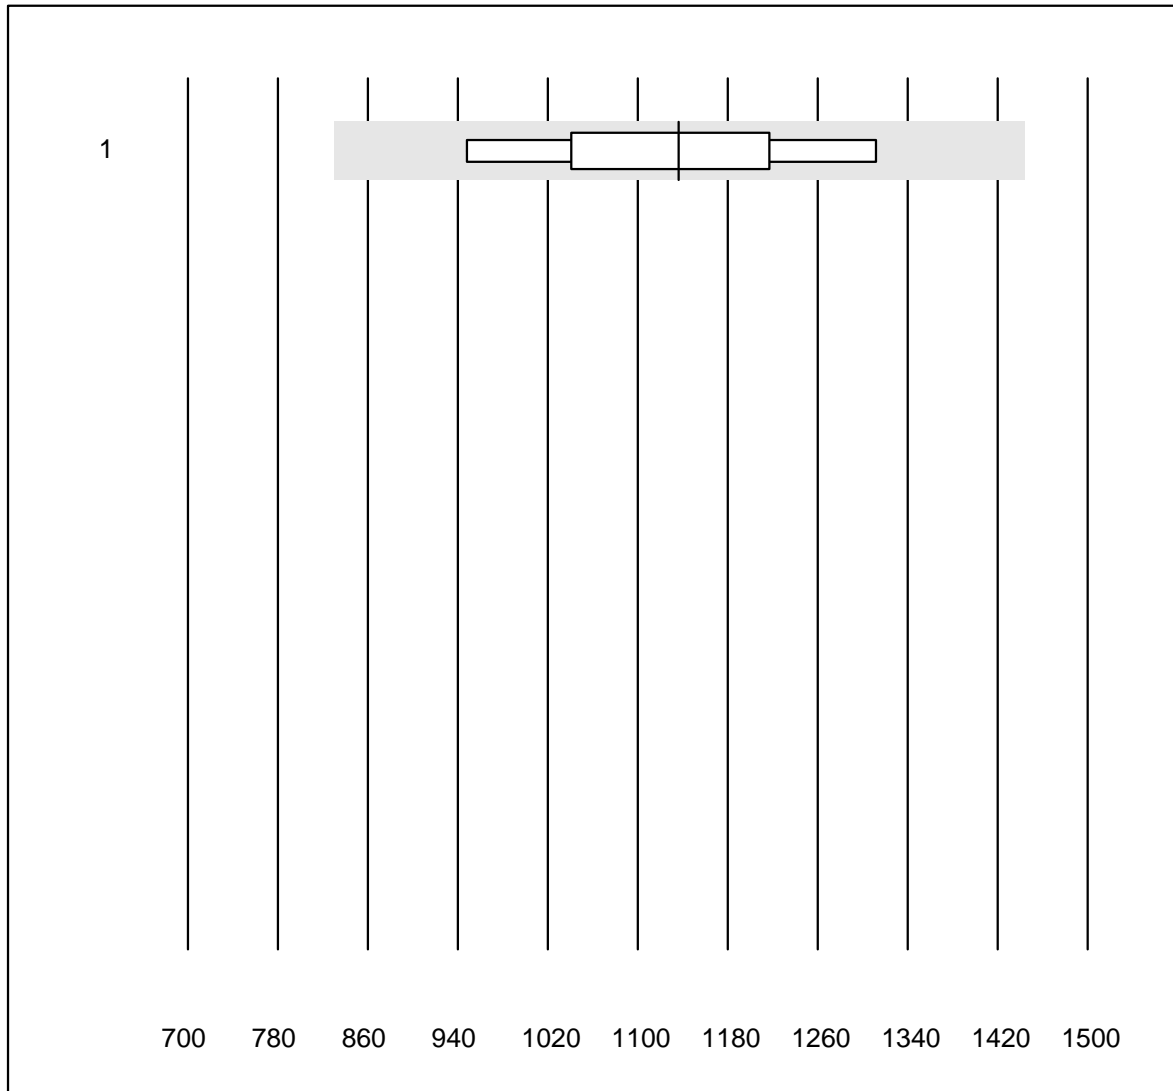


QUALAB Tolérance : 27 %

BNP (ng/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Autres méthodes	6	100.0	0.0	0.0	1136.4	11.3	e*

## NT-proBNP

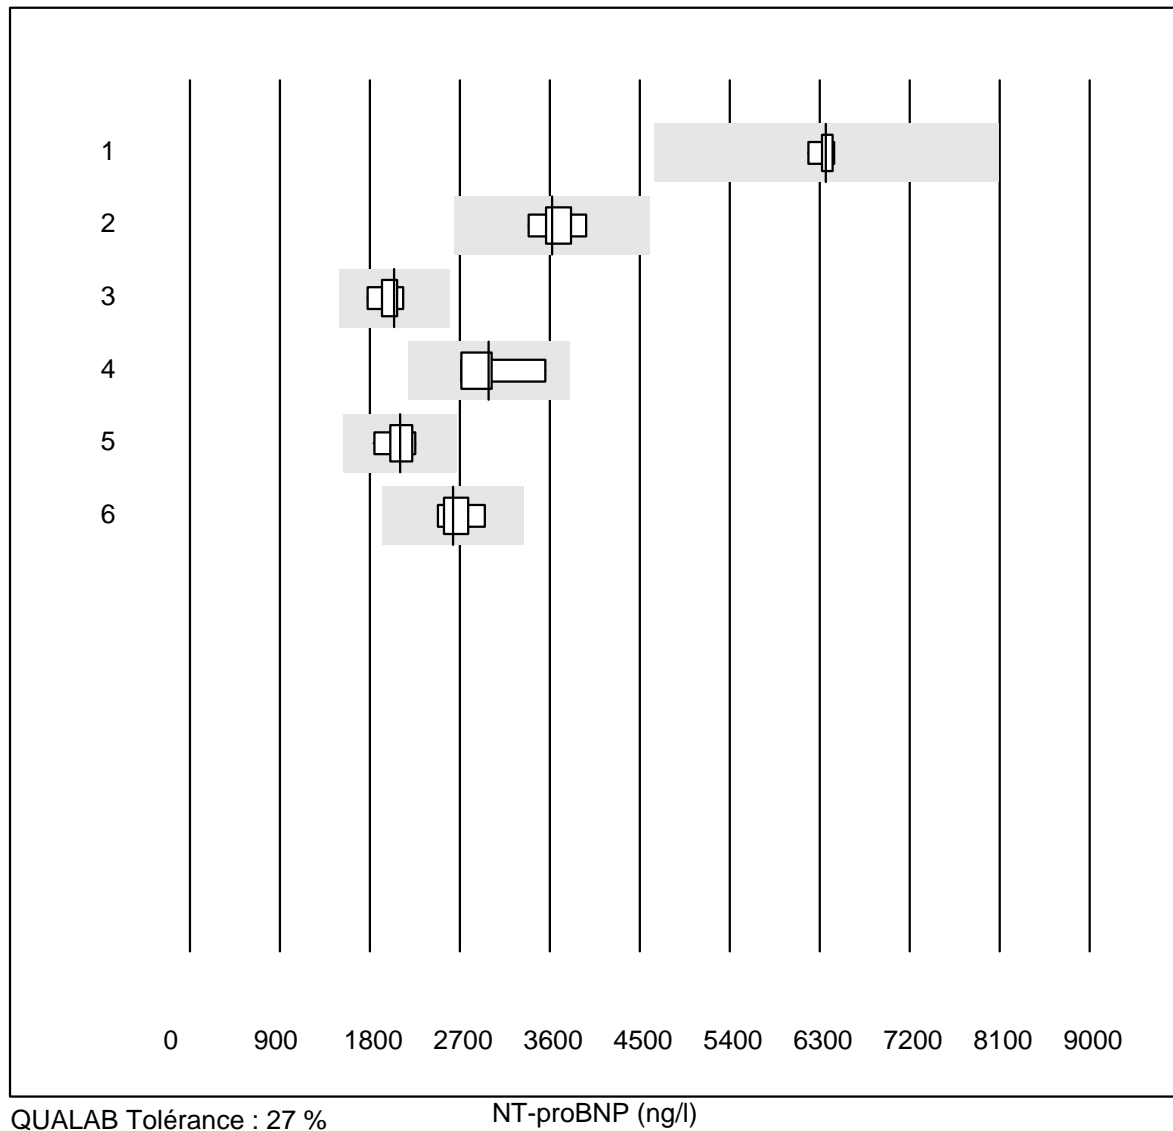

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Pathfast	6	100.0	0.0	0.0	6363.5	1.5	e
2 AQT 90 FLEX	5	100.0	0.0	0.0	3620.0	6.0	e
3 VIDAS	8	100.0	0.0	0.0	2042.0	5.7	e
4 Autres méthodes	5	80.0	0.0	20.0	2989.5	11.5	a
5 Cobas E / Elecsys	16	100.0	0.0	0.0	2104.2	6.6	e
6 Architect	7	100.0	0.0	0.0	2629.0	6.0	e


# TSH

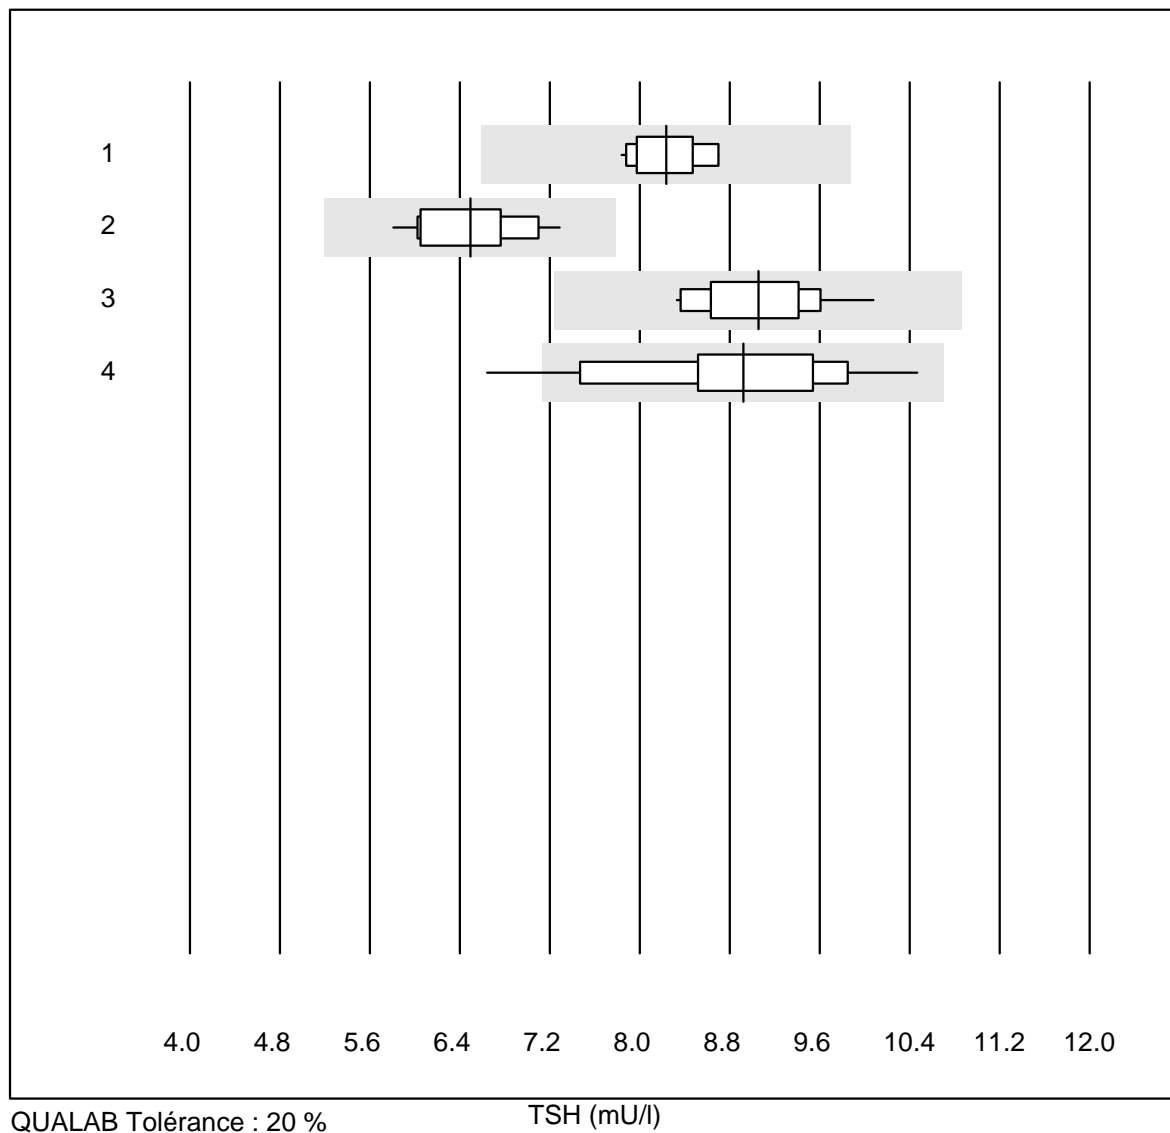

QUALAB Tolérance : 20 %

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	16	100.0	0.0	0.0	8.23	3.4	e
2 Architect	11	100.0	0.0	0.0	6.49	6.9	e
3 VIDAS	15	100.0	0.0	0.0	9.05	5.5	e
4 AFIAS	37	91.9	2.7	5.4	8.92	9.7	e

# T3

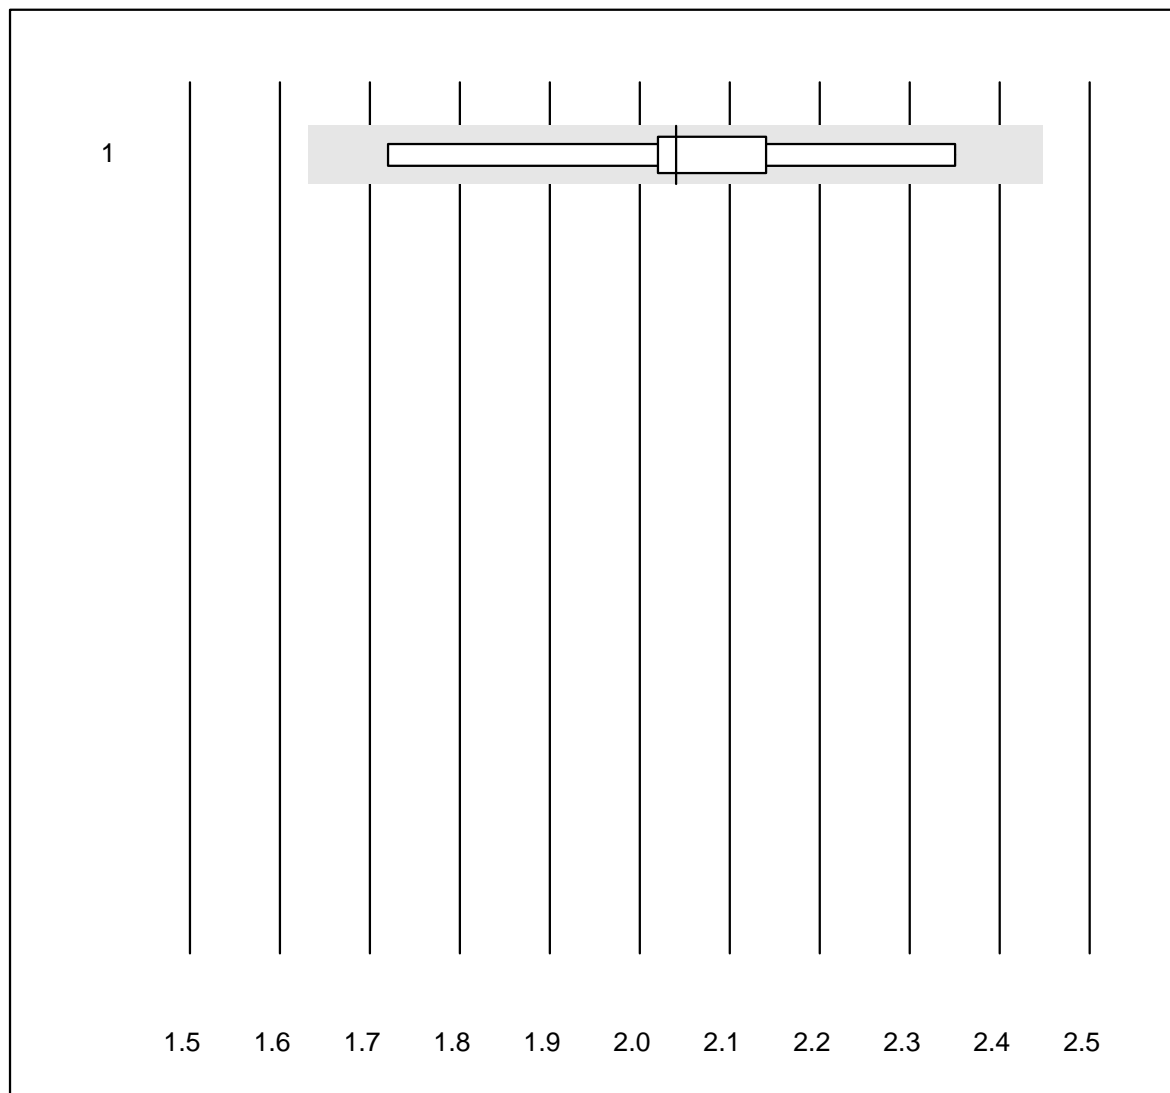


Tolérance MQ : 20 %

T3 (nmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 AFIAS	9	100.0	0.0	0.0	2.0	8.3	e*

# T4

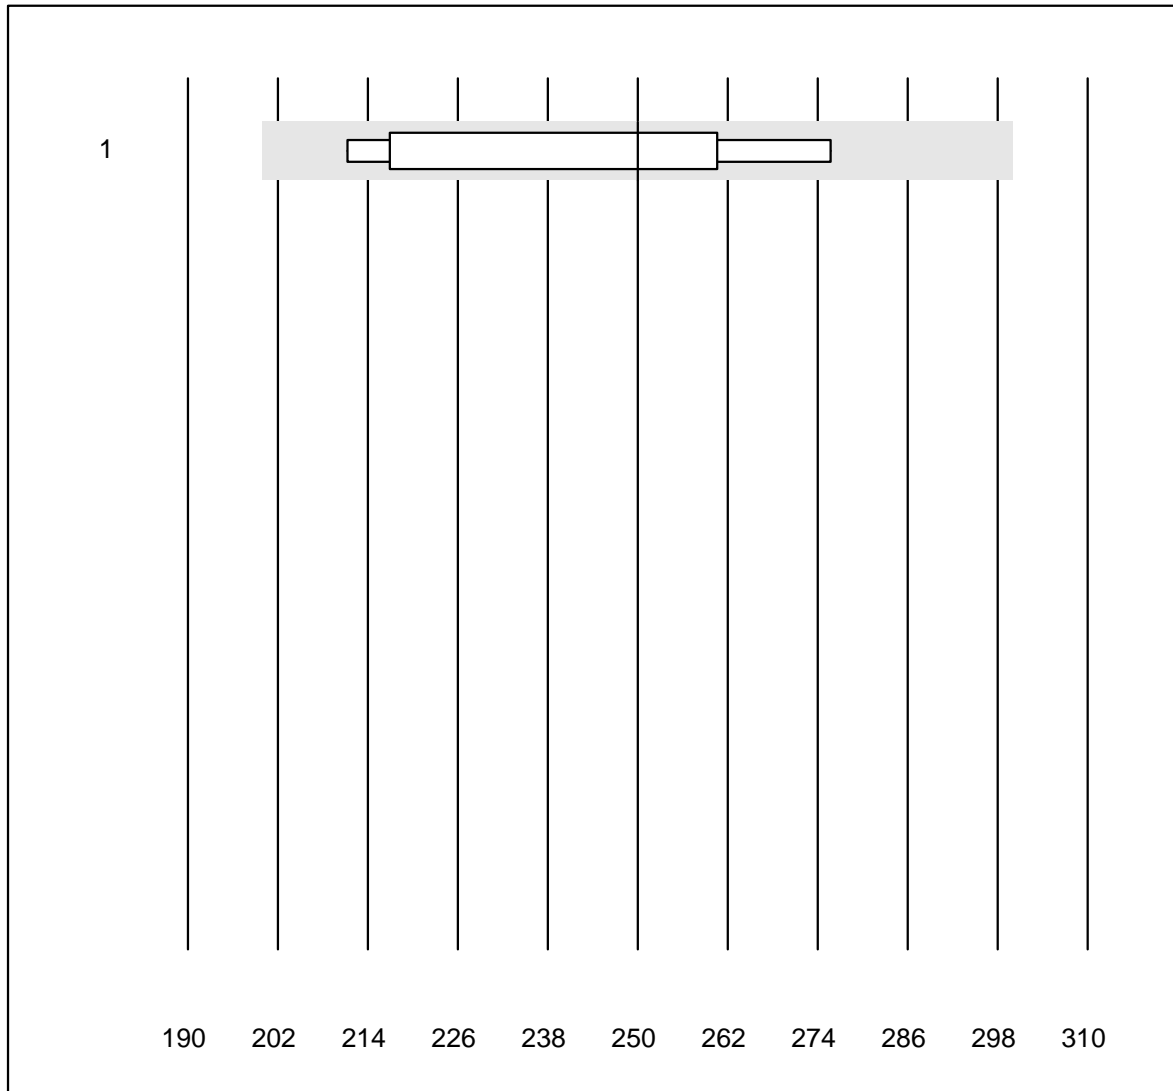


Tolérance MQ : 20 %

T4 (nmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 AFIAS	9	100.0	0.0	0.0	250	9.9	e*


## FT3

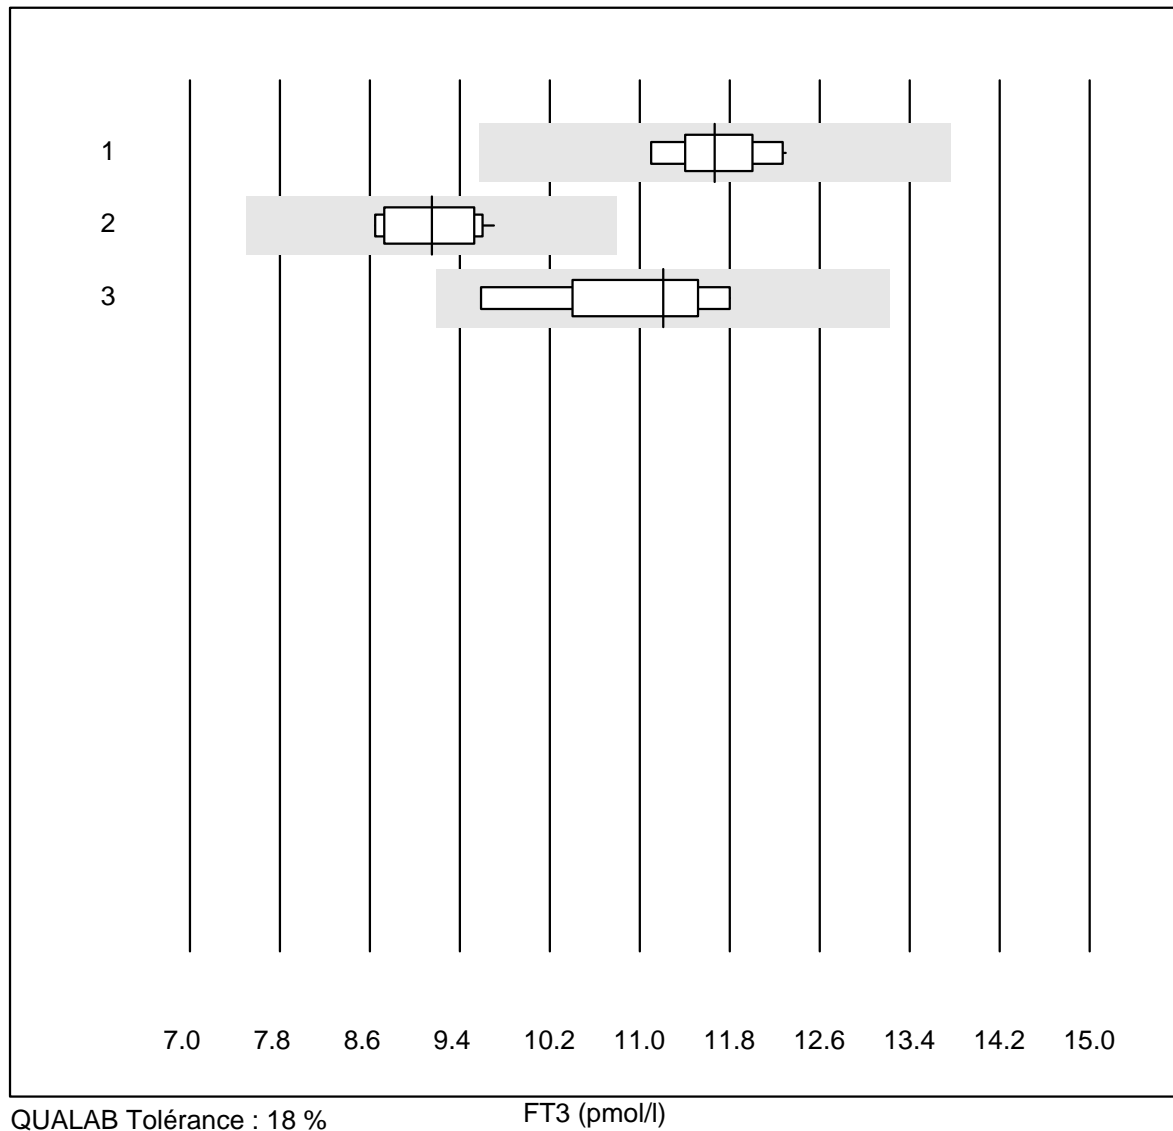

QUALAB Tolérance : 18 %

FT3 (pmol/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	16	100.0	0.0	0.0	11.7	3.2	e
2 Architect	10	100.0	0.0	0.0	9.2	4.5	e
3 VIDAS	7	100.0	0.0	0.0	11.2	7.0	e*

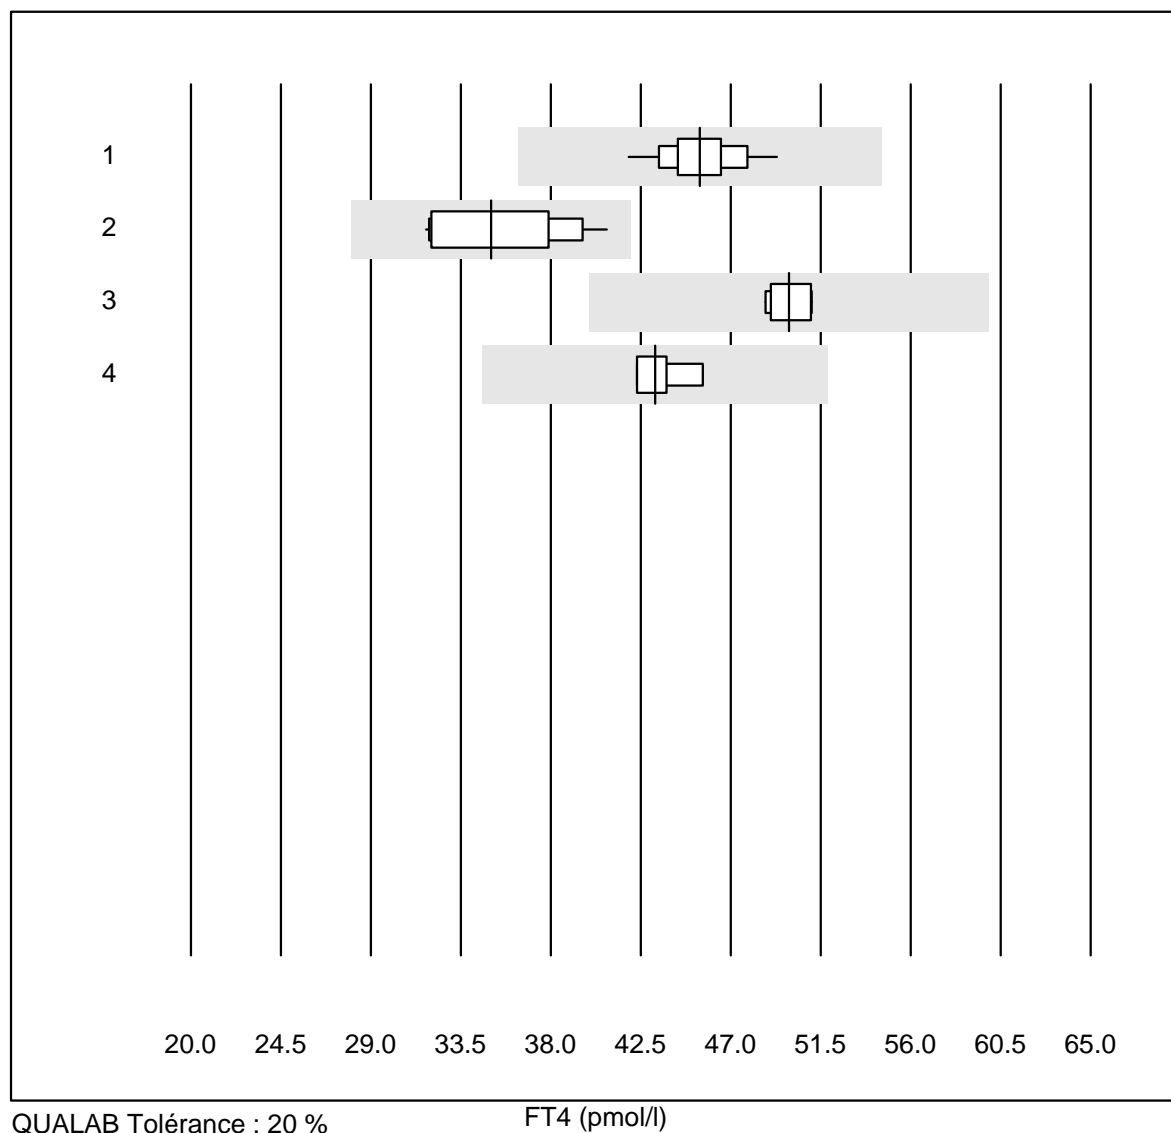**FT4**

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	16	100.0	0.0	0.0	45.5	4.0	e
2 Architect	11	100.0	0.0	0.0	35.0	9.4	e*
3 VIDAS	7	100.0	0.0	0.0	49.9	1.9	e
4 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	43.2	3.4	e



# Testostérone

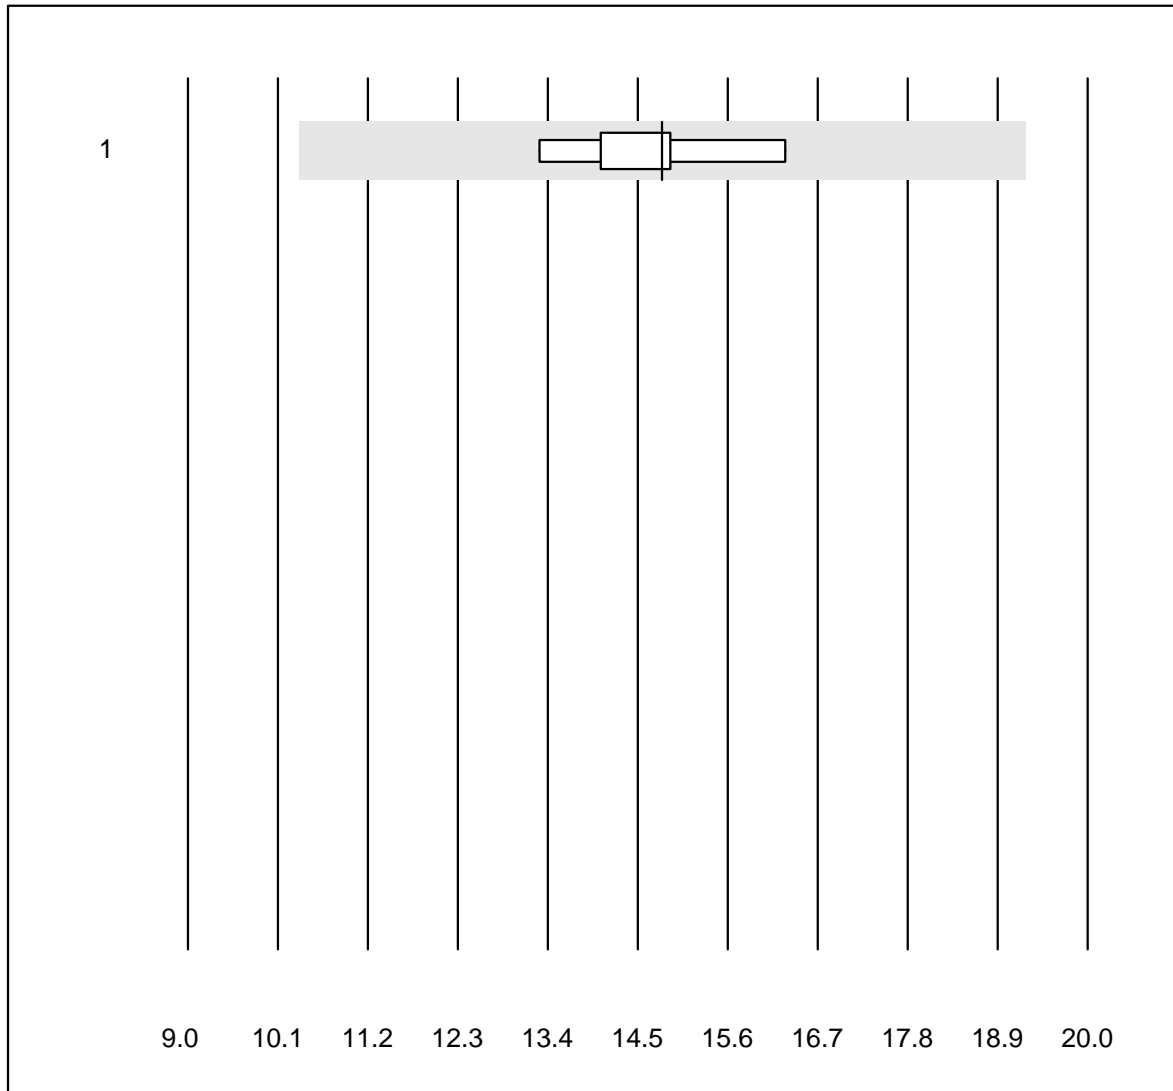


QUALAB Tolérance : 30 %

Testostérone (nmol/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	8	100.0	0.0	0.0	14.8	5.8	e

# Estradiol

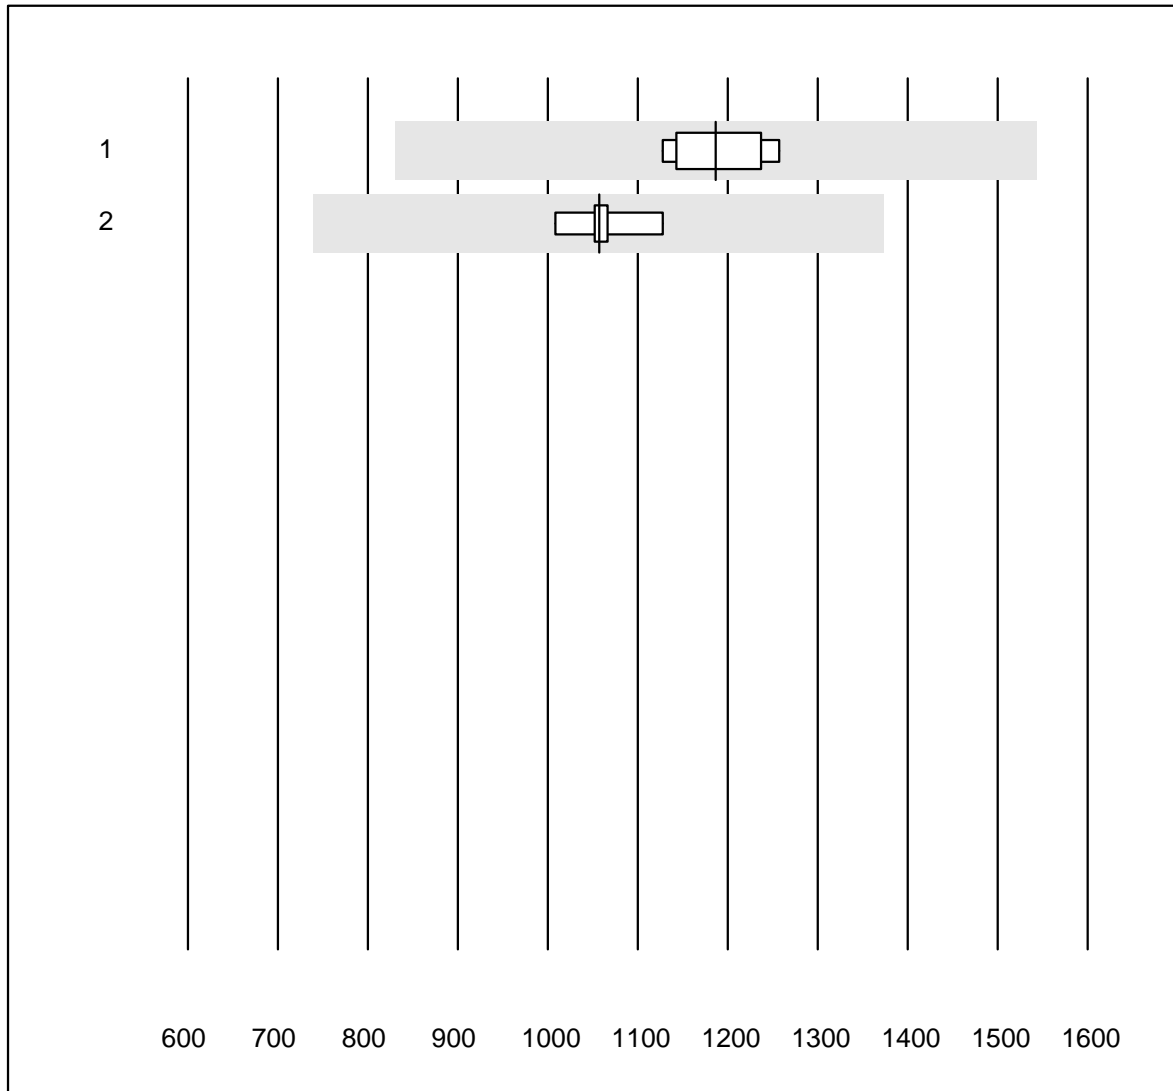


QUALAB Tolérance : 30 %

Estradiol (pmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	7	100.0	0.0	0.0	1187	4.2	e
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	1057	4.1	e

# SHBG

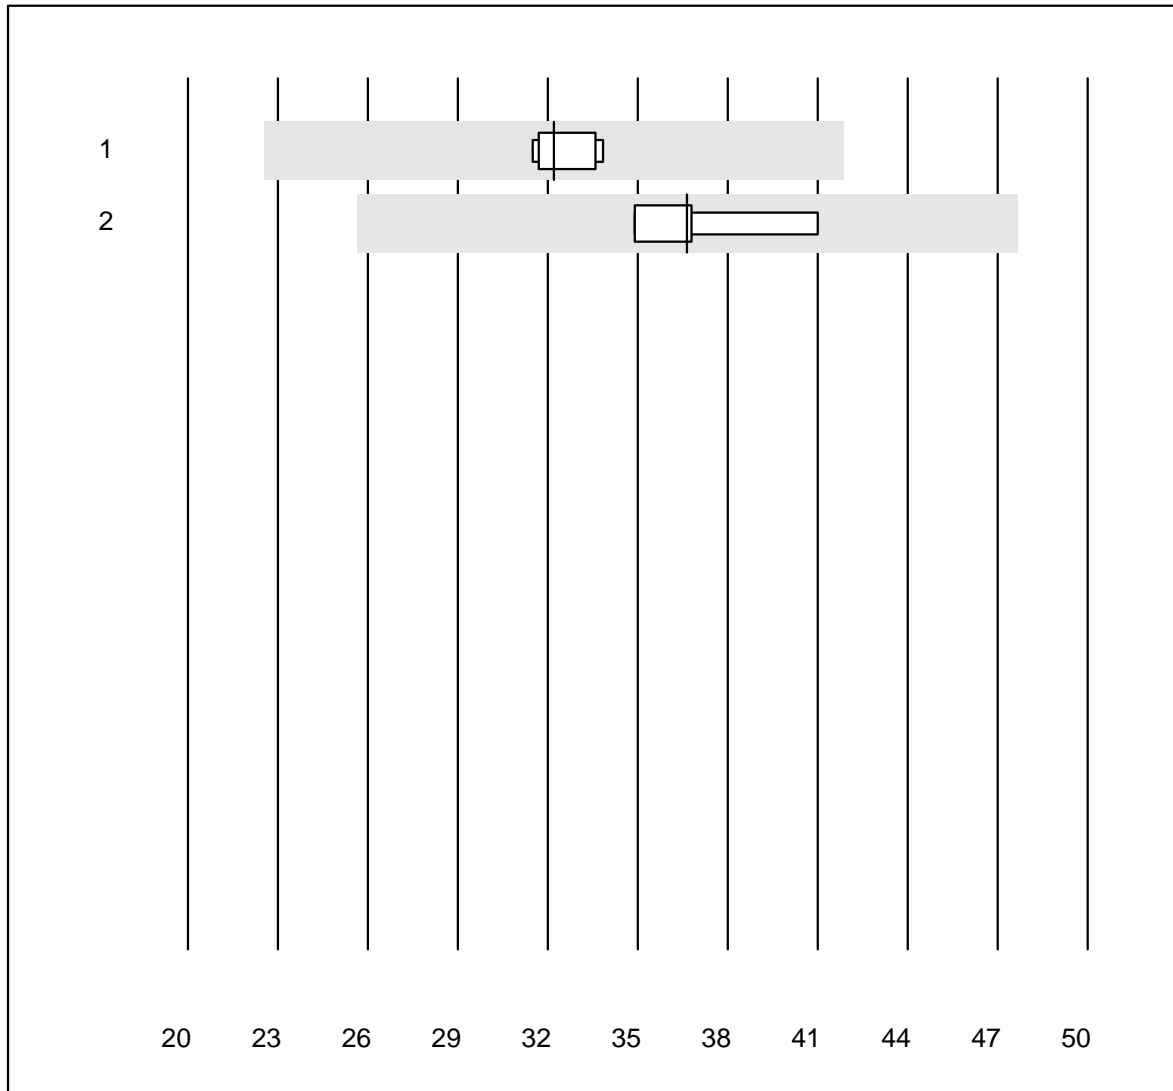


Tolérance MQ : 30 %

SHBG (nmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	6	100.0	0.0	0.0	32.2	3.0	e
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	36.7	7.0	e

## Cortisol

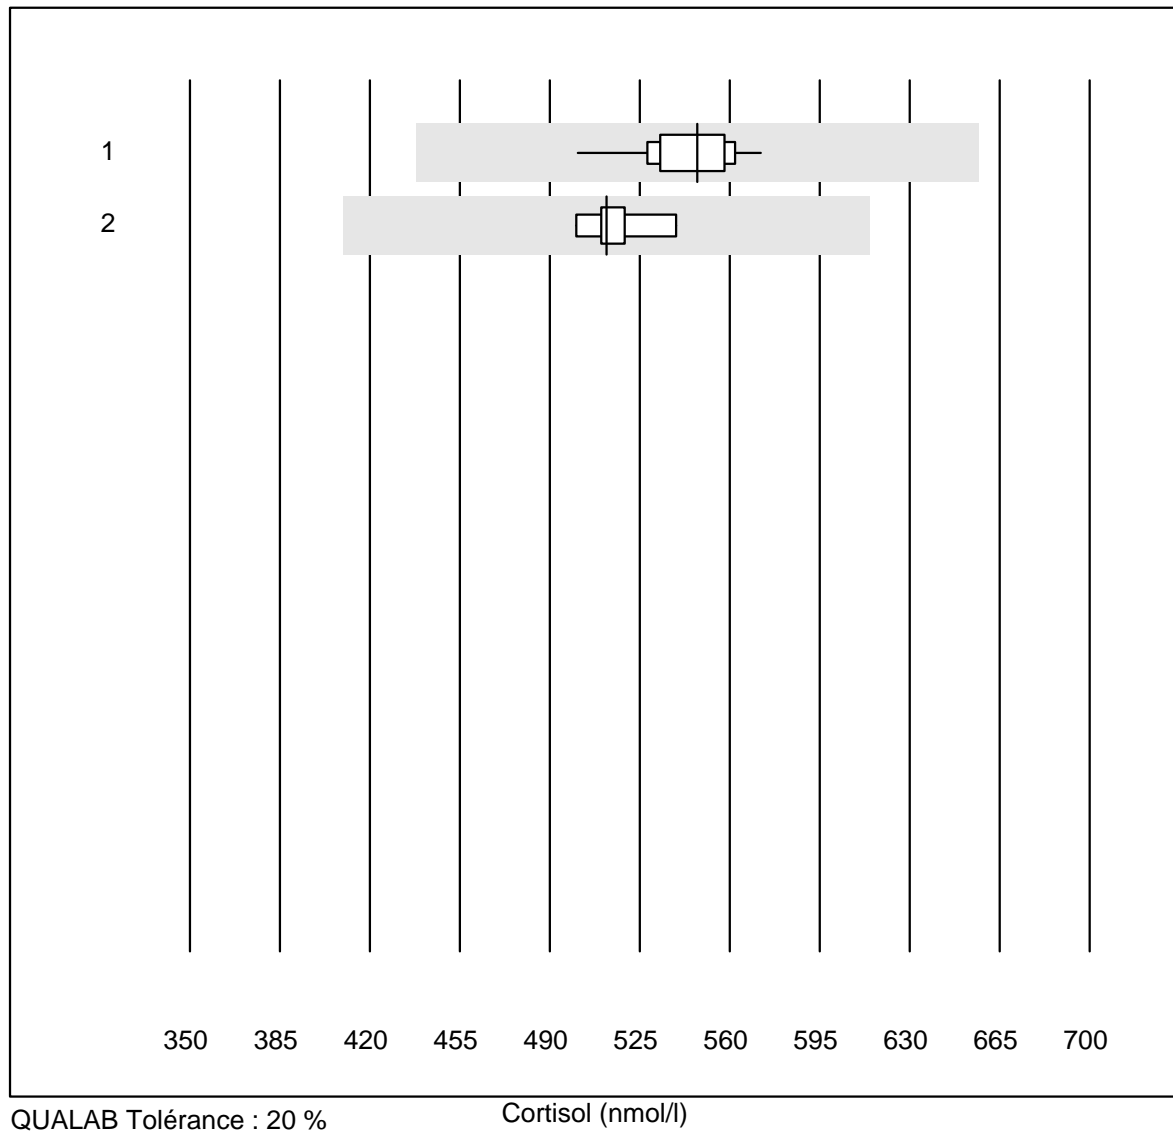


QUALAB Tolérance : 20 %

Cortisol (nmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	11	100.0	0.0	0.0	547	3.5	e
2 Architect	6	100.0	0.0	0.0	512	2.5	e


# Progesteron

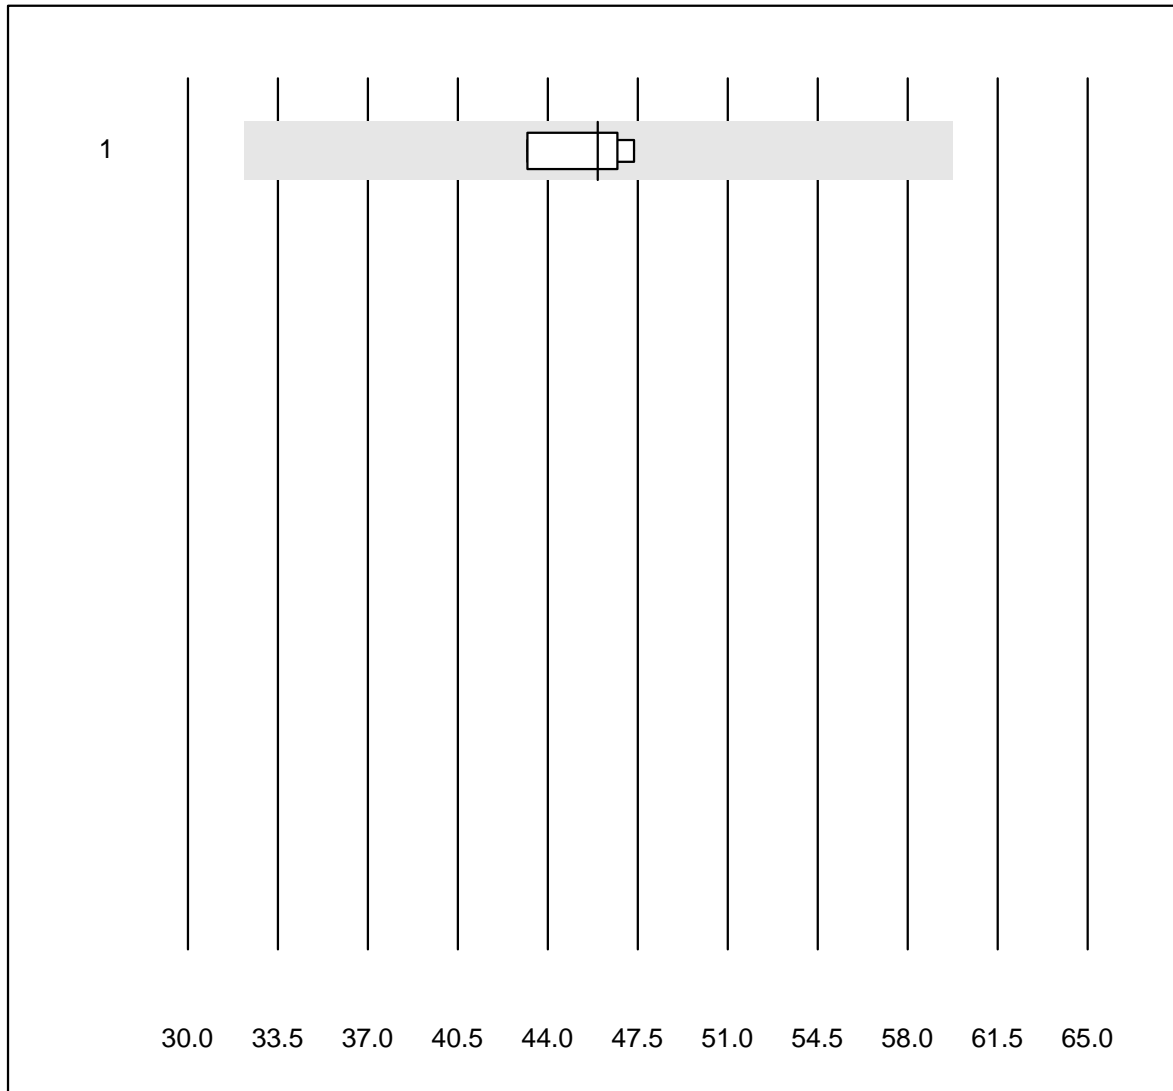

Tolérance MQ : 30 %

Progesteron (nmol/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	46.0	4.0	e

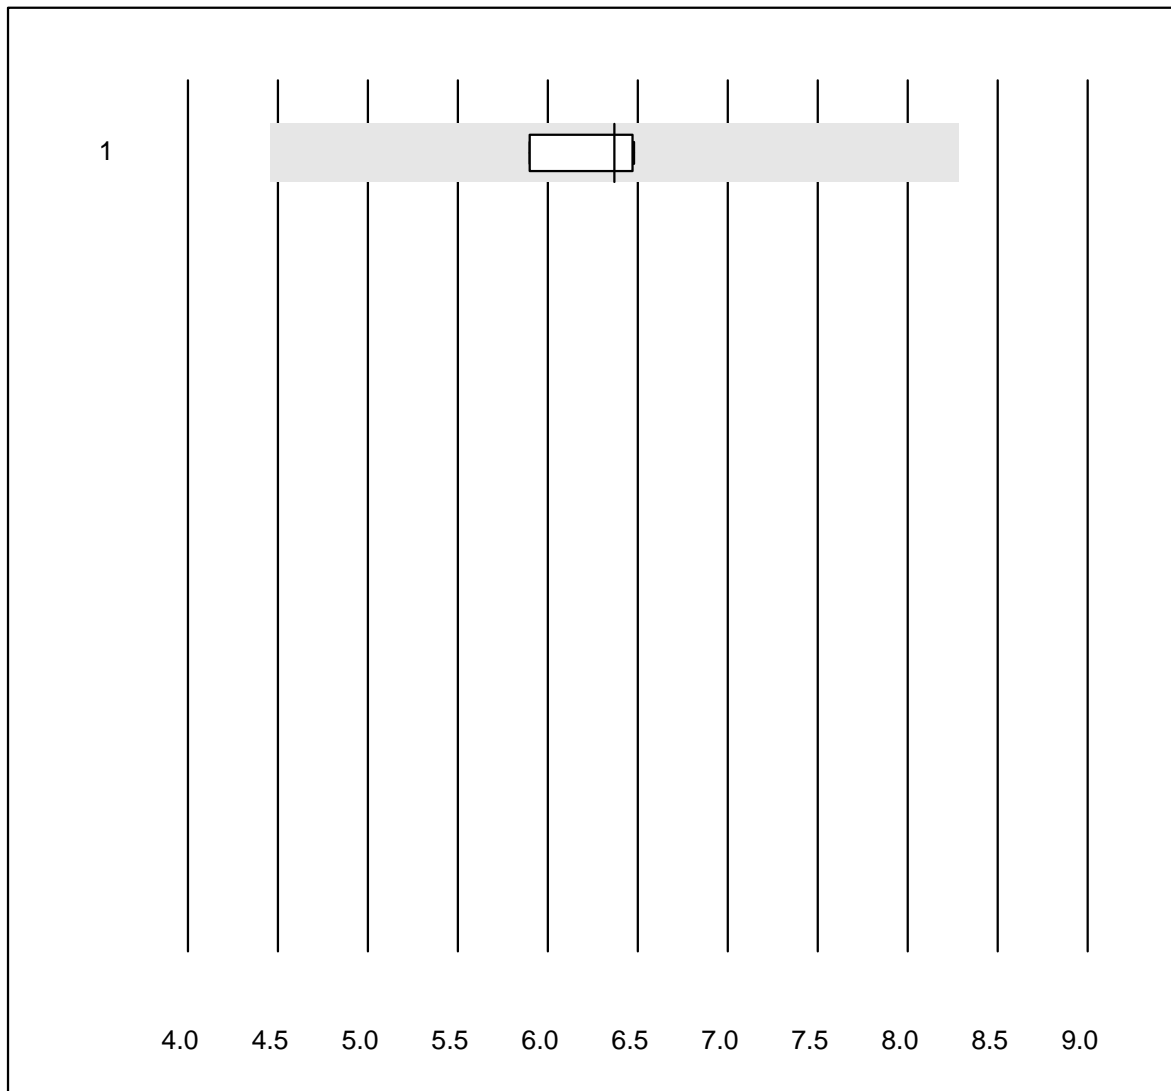
**DHEAS**

Tolérance MQ : 30 %

DHEAS (µmol/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	6.37	4.3	e

## Luteinisierendes Hormon

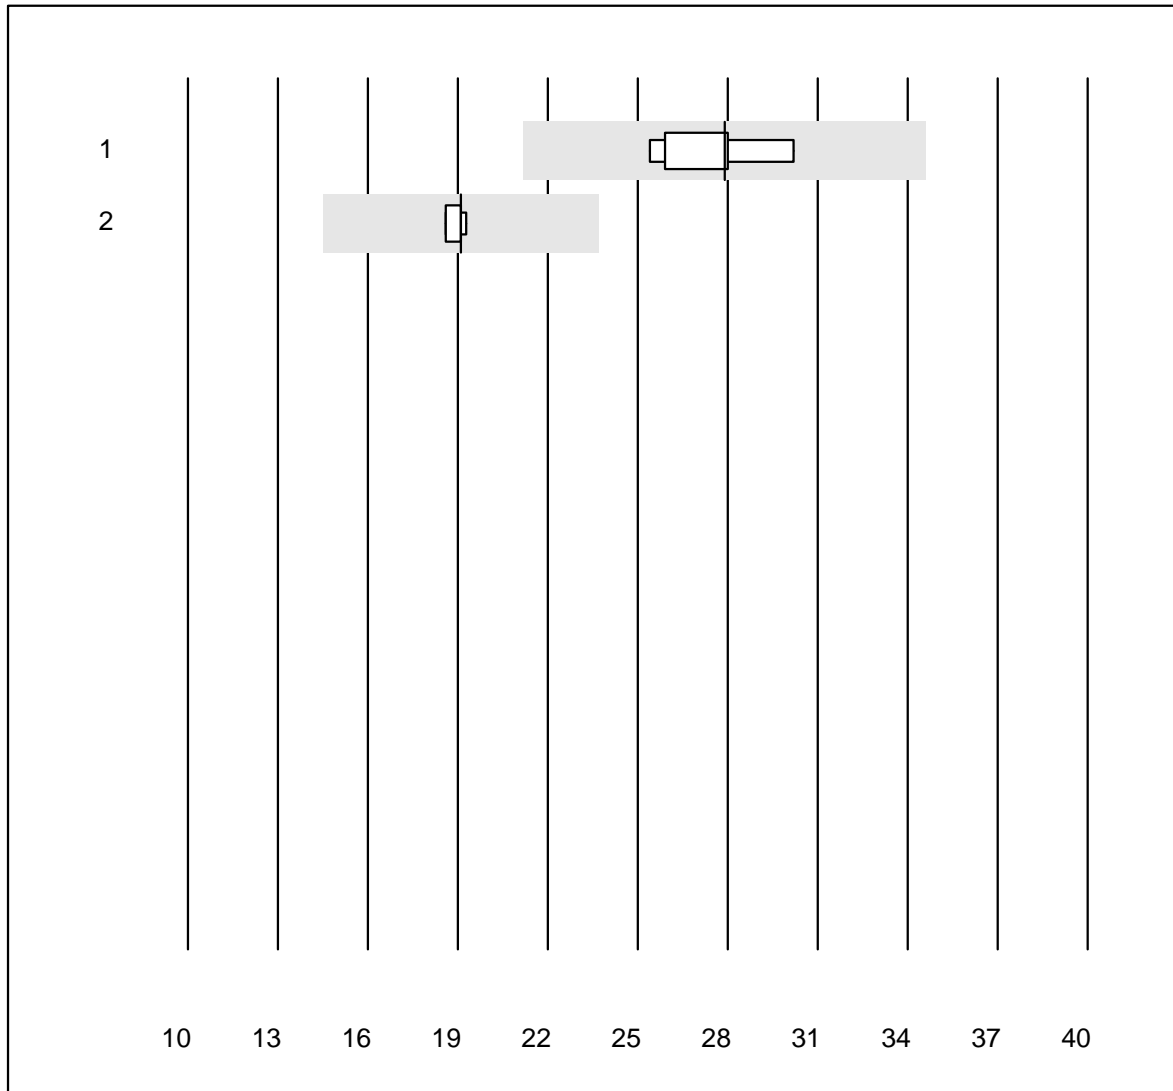


QUALAB Tolérance : 24 %

Luteinisierendes Hormon (U/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Roche, Cobas	8	100.0	0.0	0.0	27.9	5.6	e
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	19.1	1.5	e

## Follikelstimulierendes Hormon

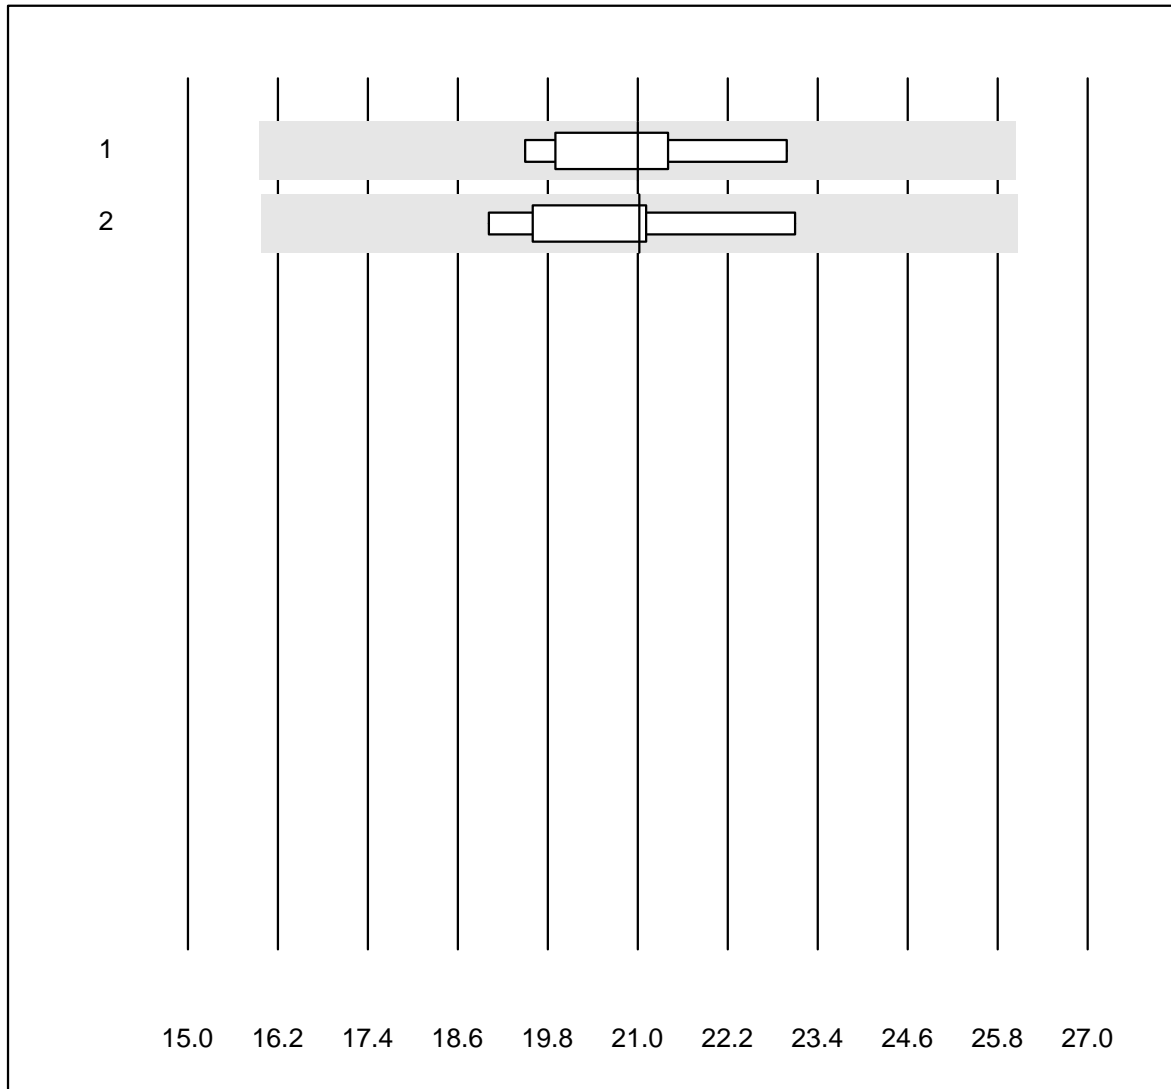


QUALAB Tolérance : 24 % Follikelstimulierendes Hormon (U/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Roche, Cobas	8	100.0	0.0	0.0	21.0	5.3	e
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	21.0	7.6	e*



## Prolaktin (PRL)

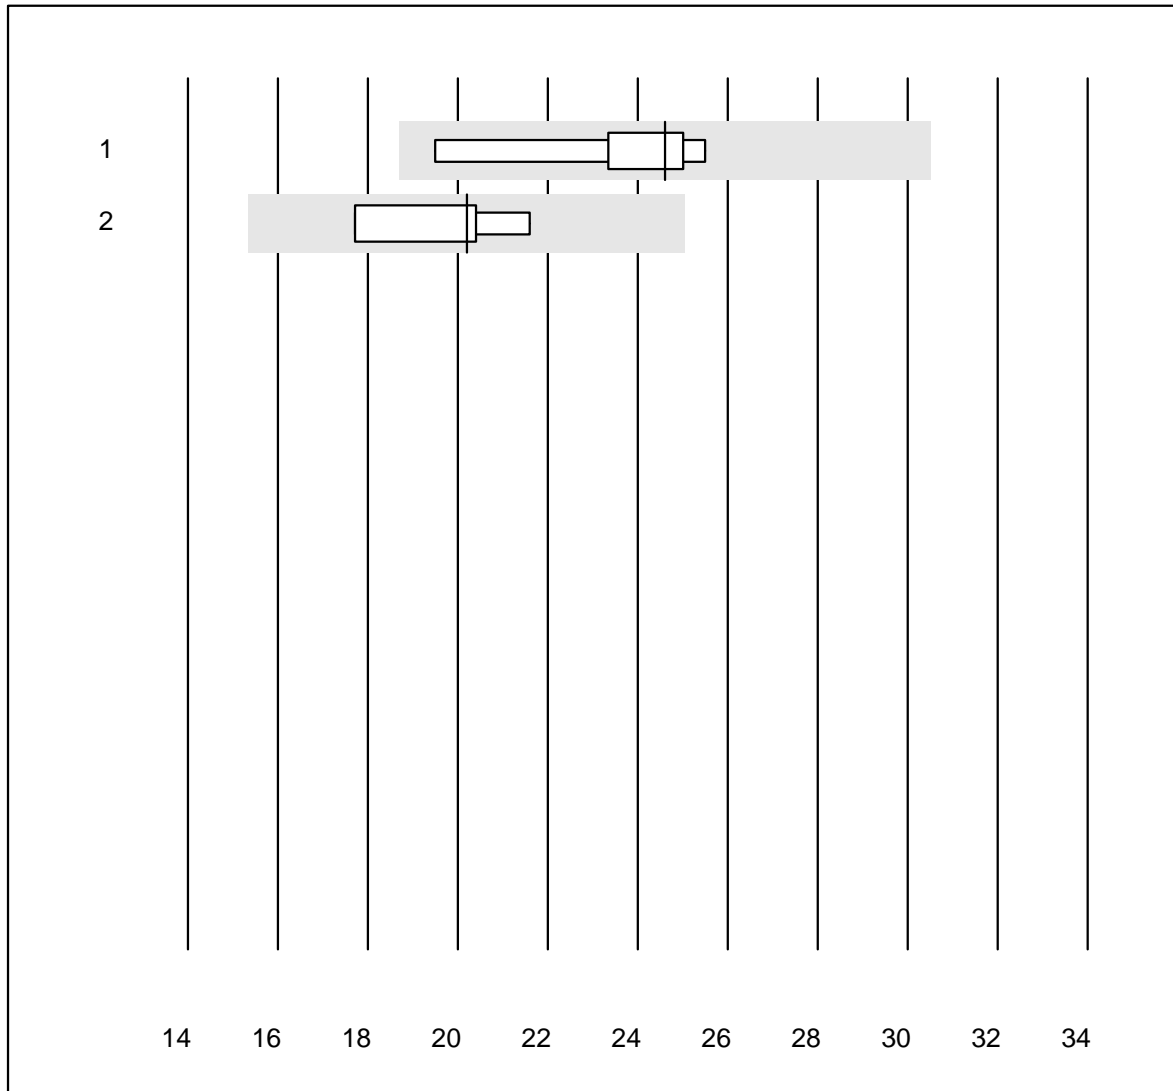


QUALAB Tolérance : 24 %

Prolaktin (PRL) (µg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas/Roche	9	100.0	0.0	0.0	24.6	7.9	e
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	20.2	8.1	e*

# Insulin

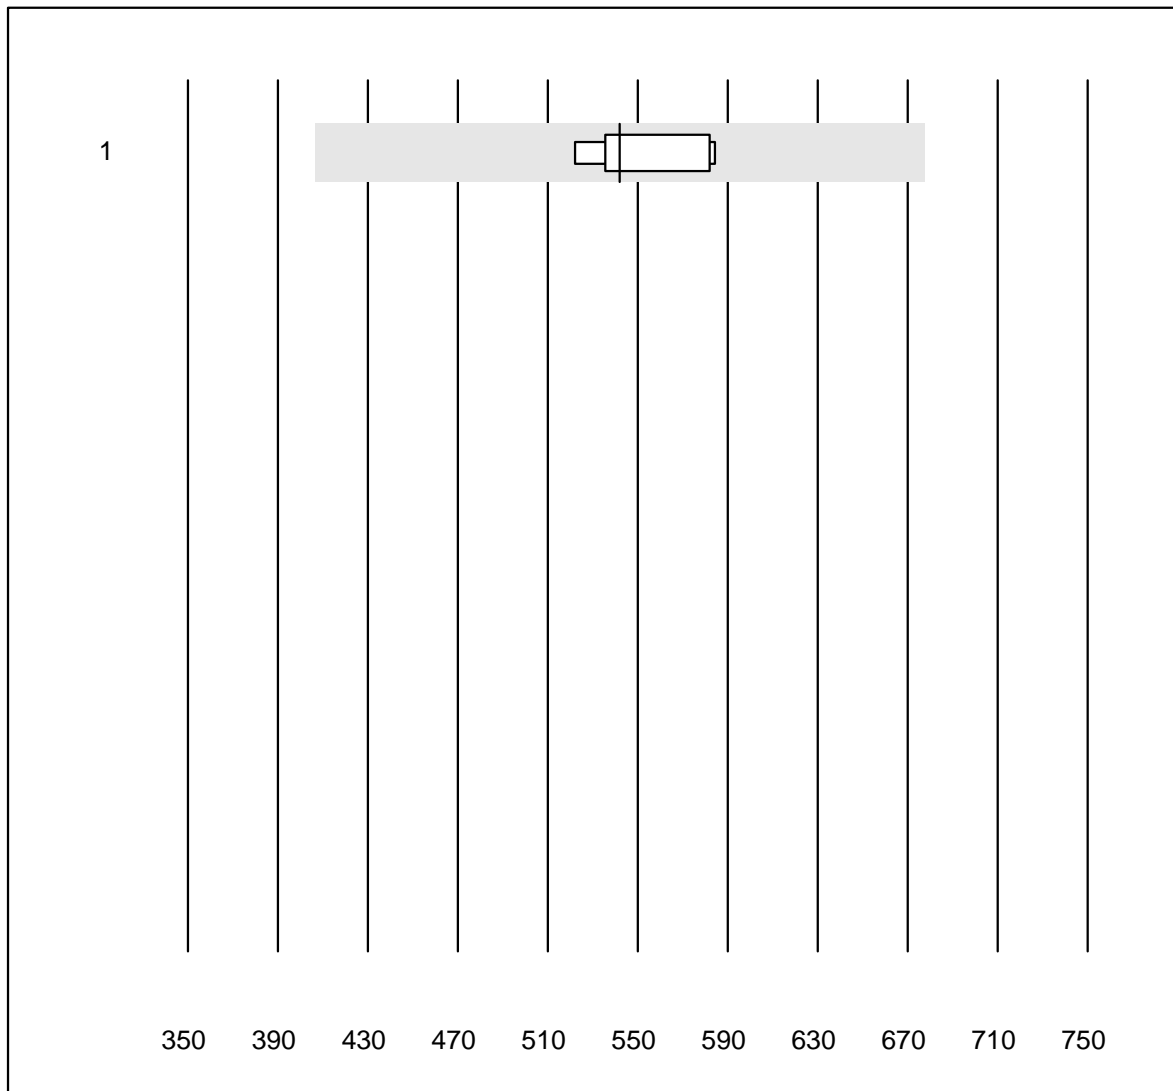


Tolérance MQ : 25 %

Insulin (pmol/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	7	100.0	0.0	0.0	542	4.7	e

# HGH

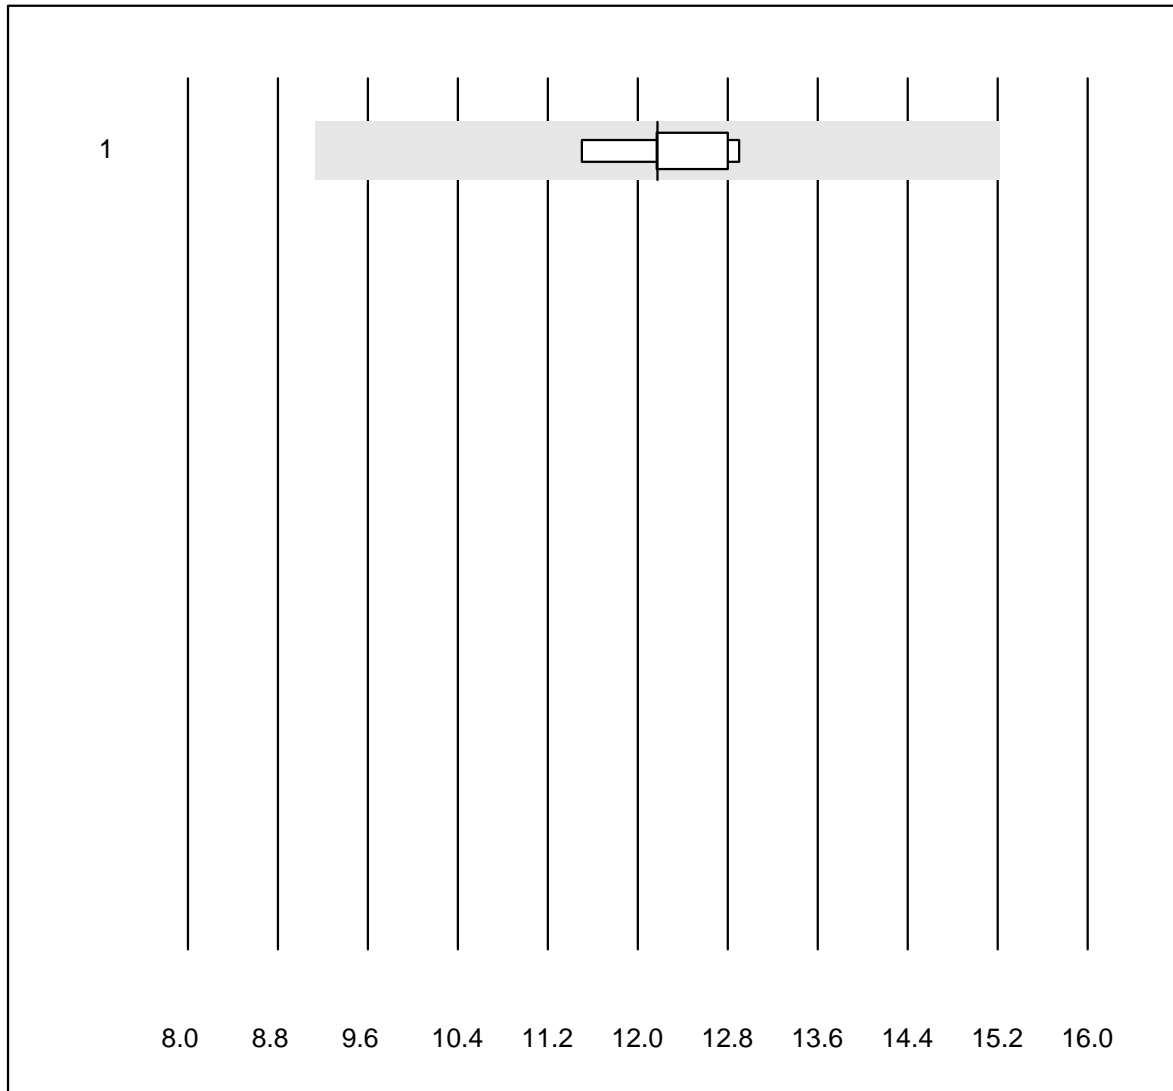


Tolérance MQ : 25 %

HGH (µg/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	12.17	4.6	e

## Freies Testostéron

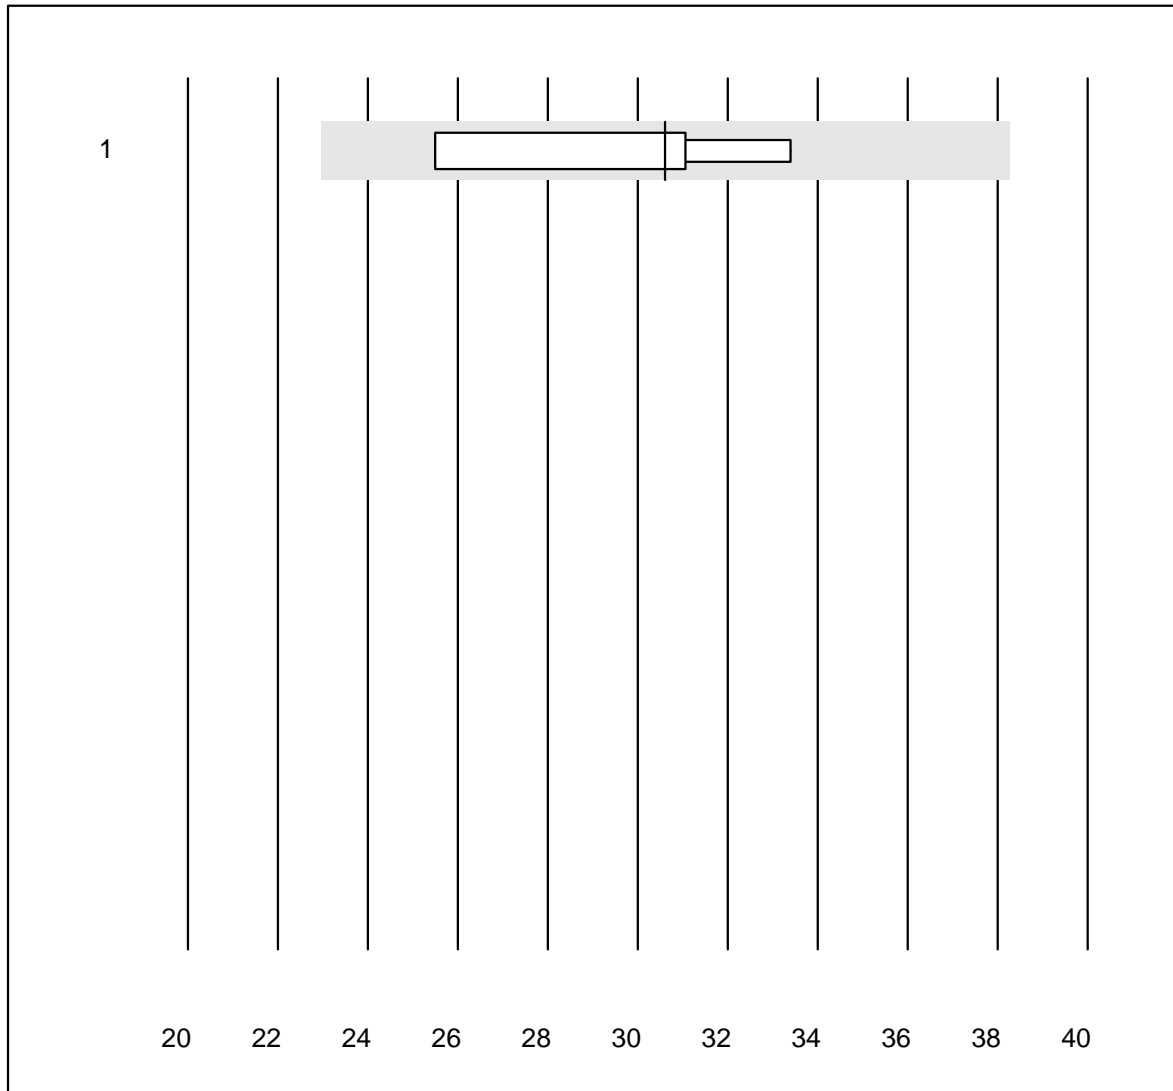


Tolérance MQ : 25 %

Freies Testostéron (pmol/l)


No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	30.6	11.0	e*

## IGF-1

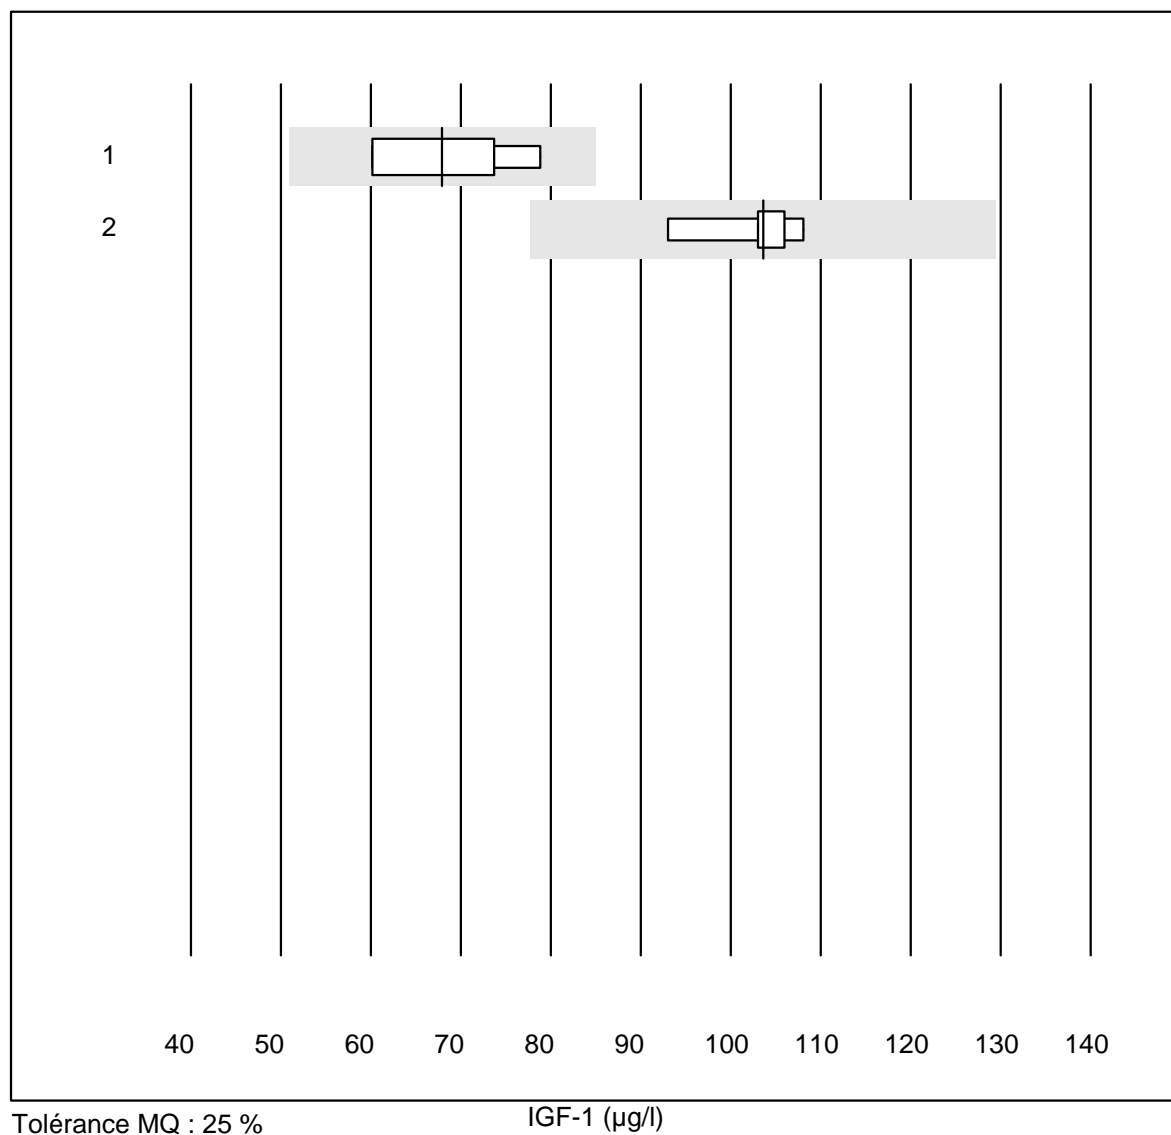

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	68	13.1	e*
2 Liaison	5	100.0	0.0	0.0	104	5.7	e

## Troponine T CR

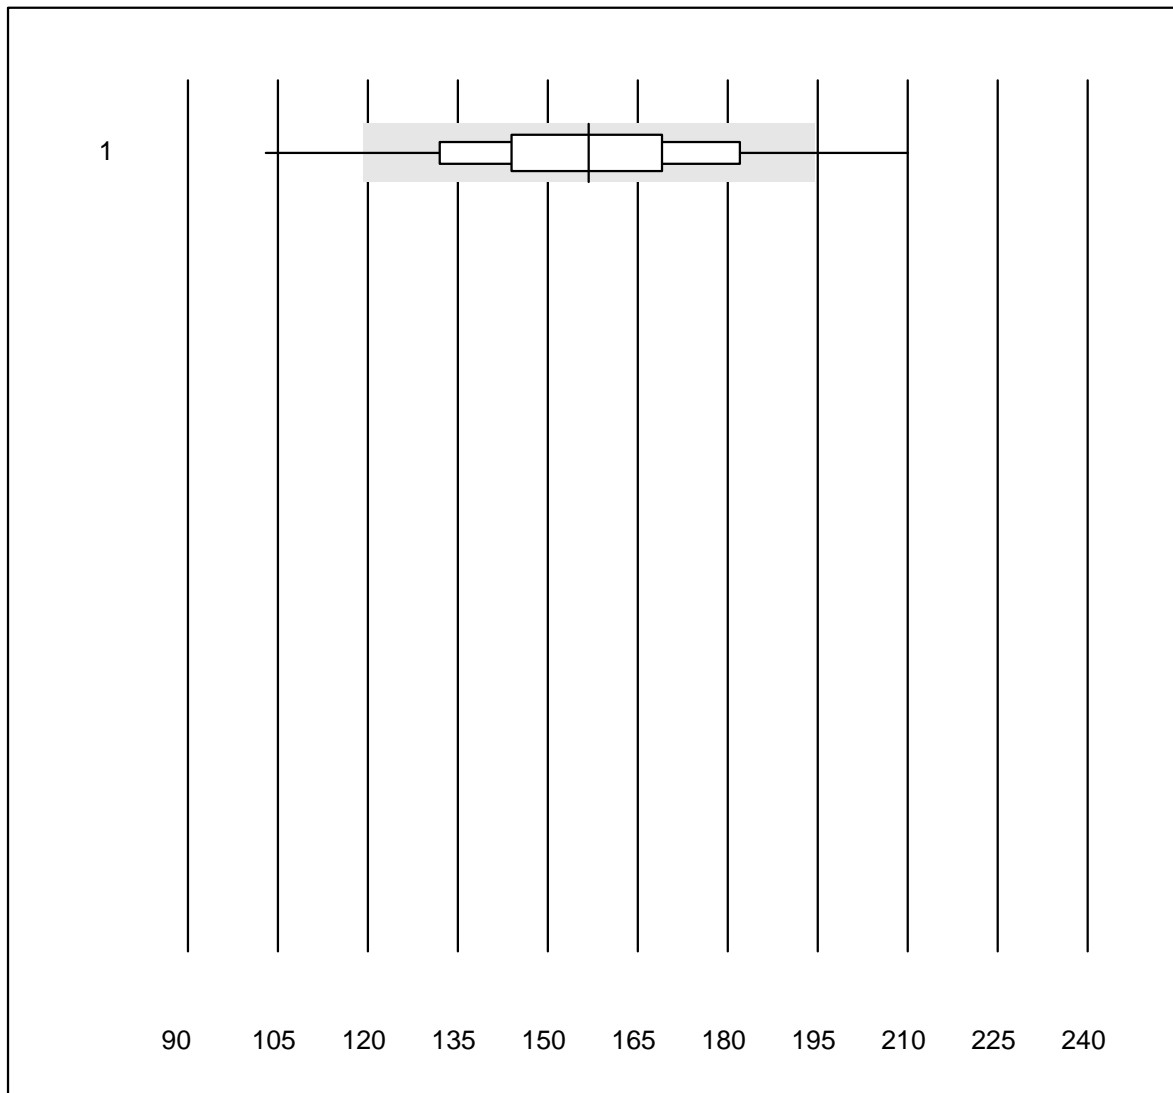


QUALAB Tolérance : 24 %

Troponine T CR (ng/l)


No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas h 232	1293	92.8	5.3	1.9	156.85	12.3	e

## D-Dimères CR

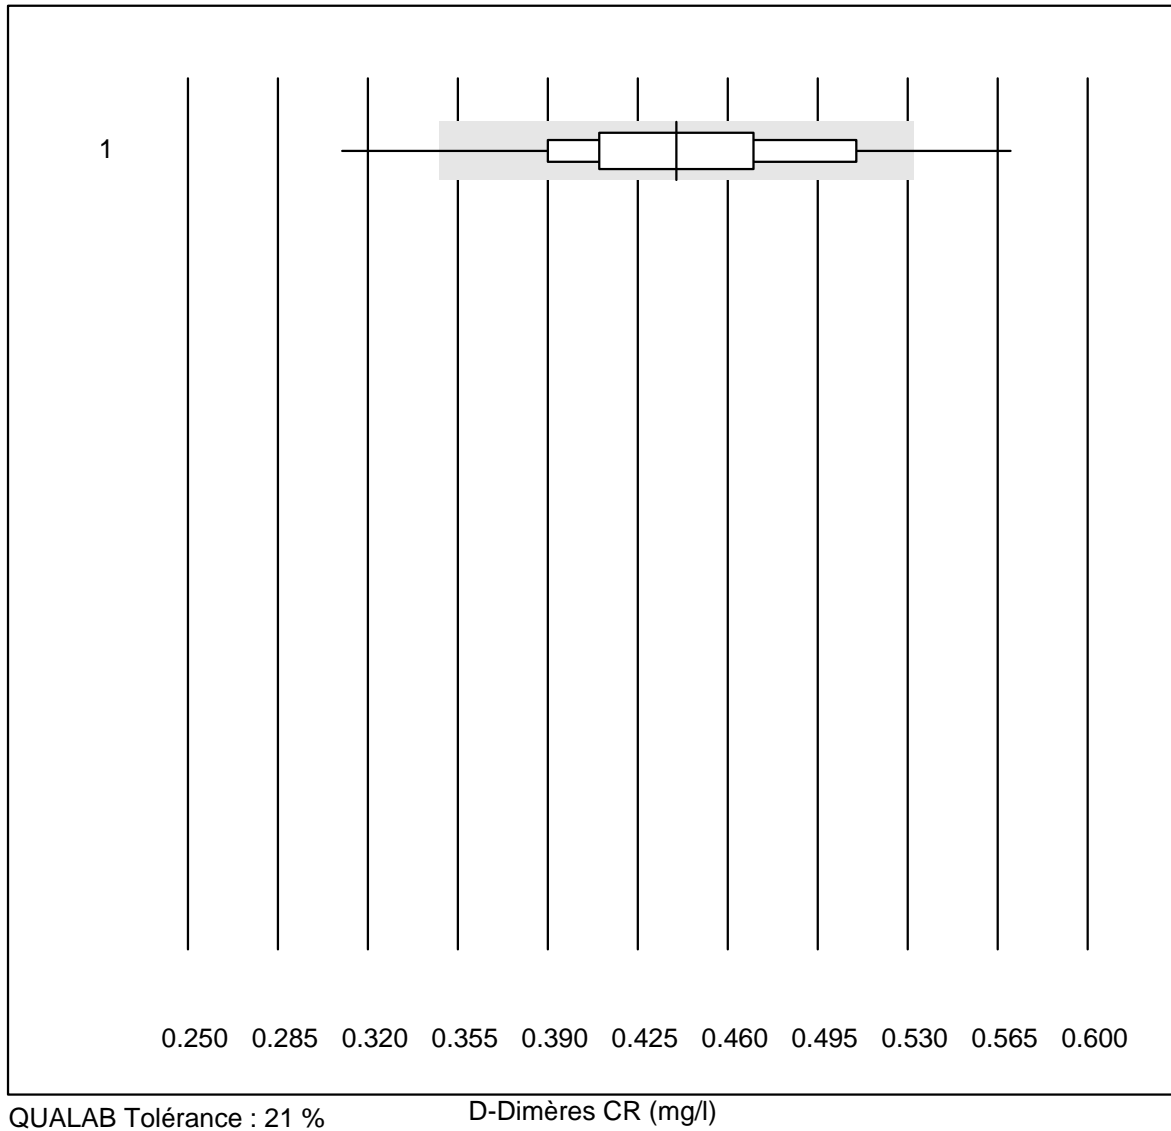

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas h 232	1267	94.4	3.9	1.7	0.44	10.3	e

## CKMB- K8

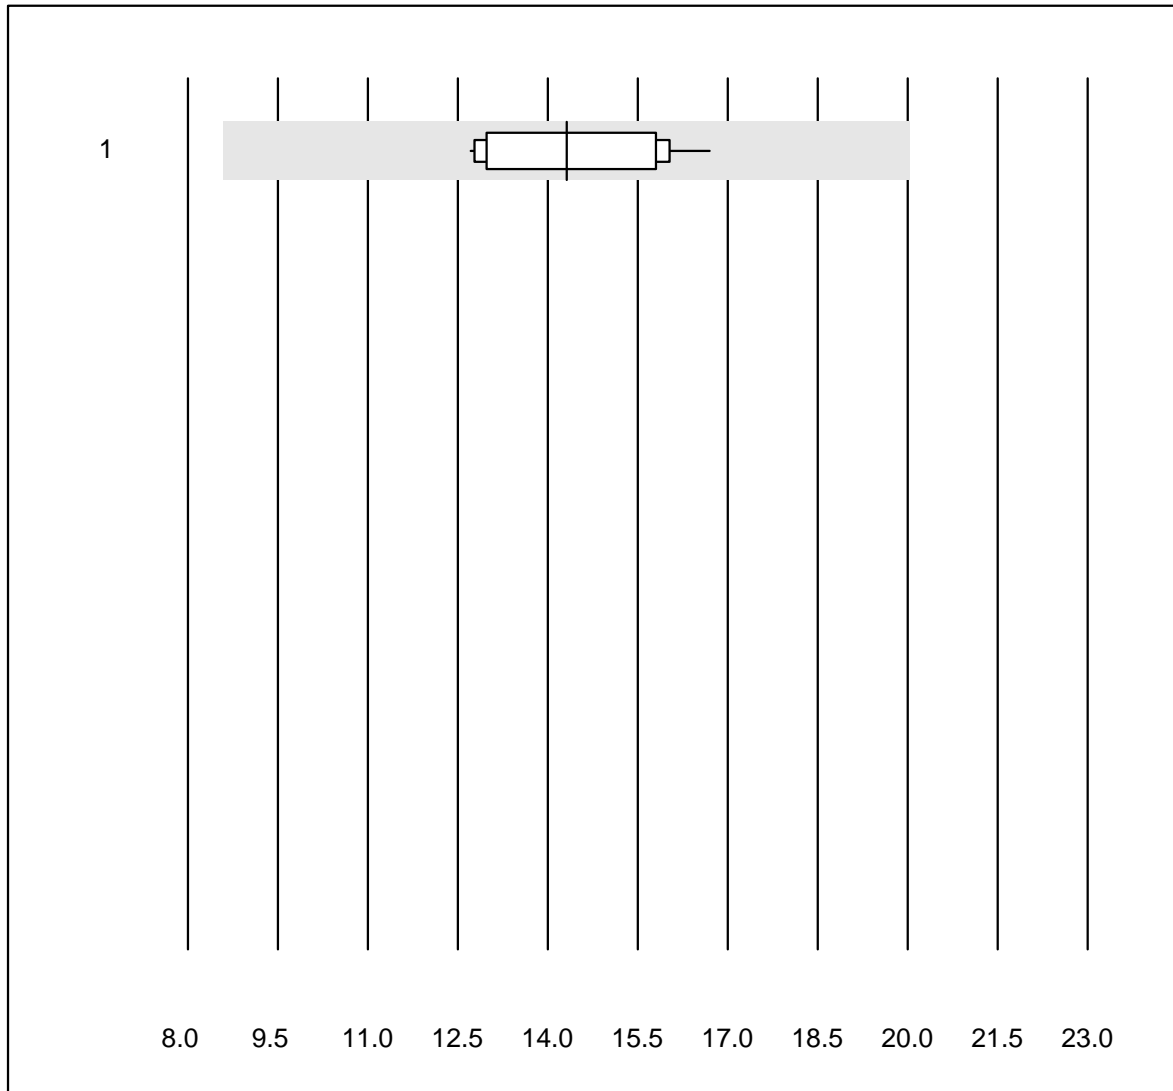


Tolérance MQ : 40 %

CKMB- K8 (µg/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas h 232	11	100.0	0.0	0.0	14.3	9.5	e




## NT-proBNP CR

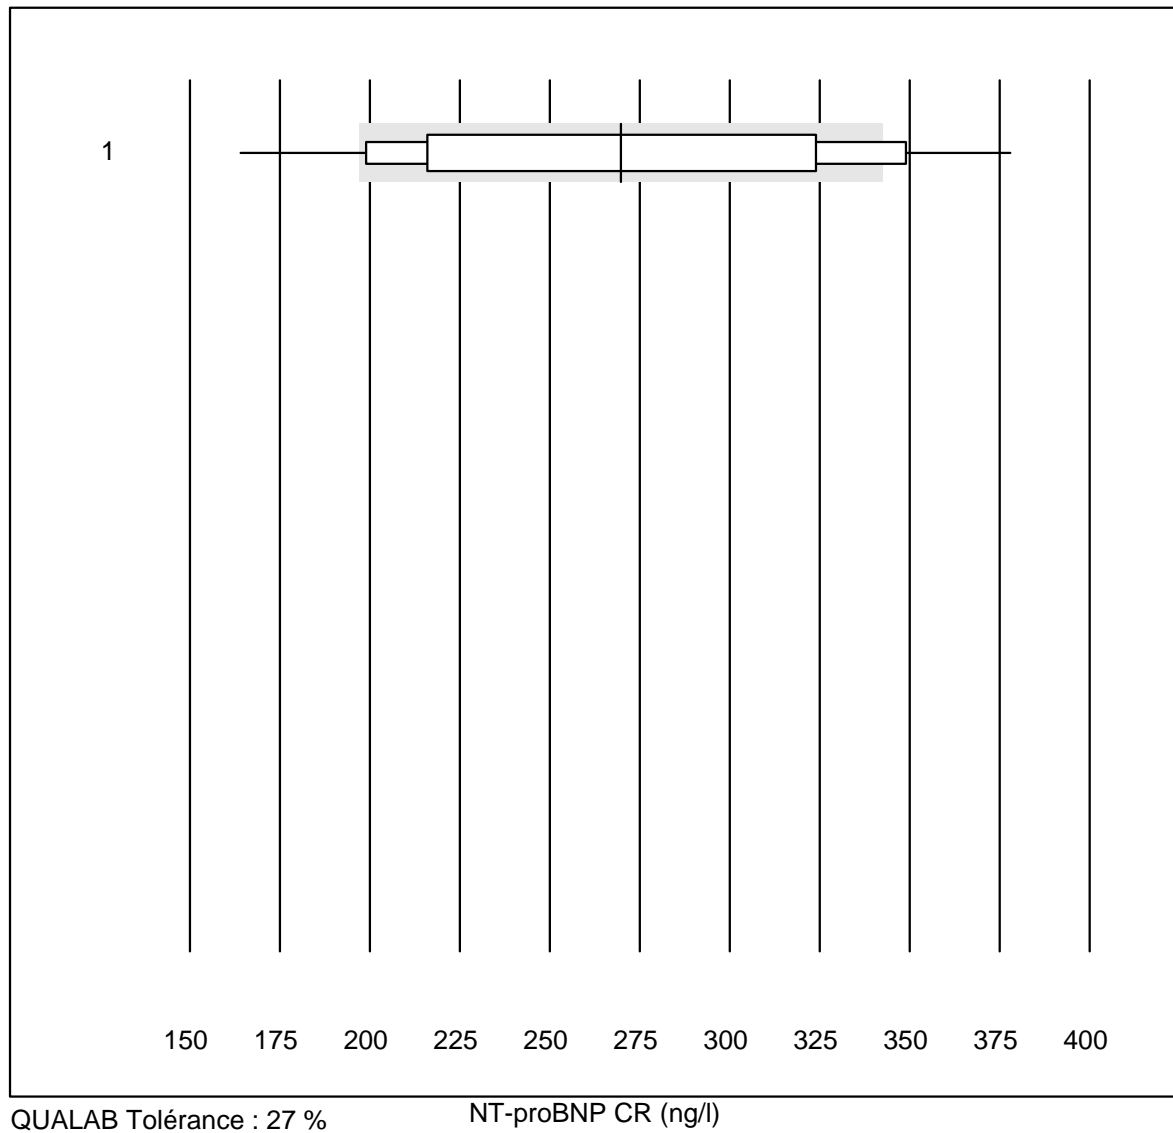

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas h 232	801	76.4	20.1	3.5	270	21.5	e

## PCO2 CCA

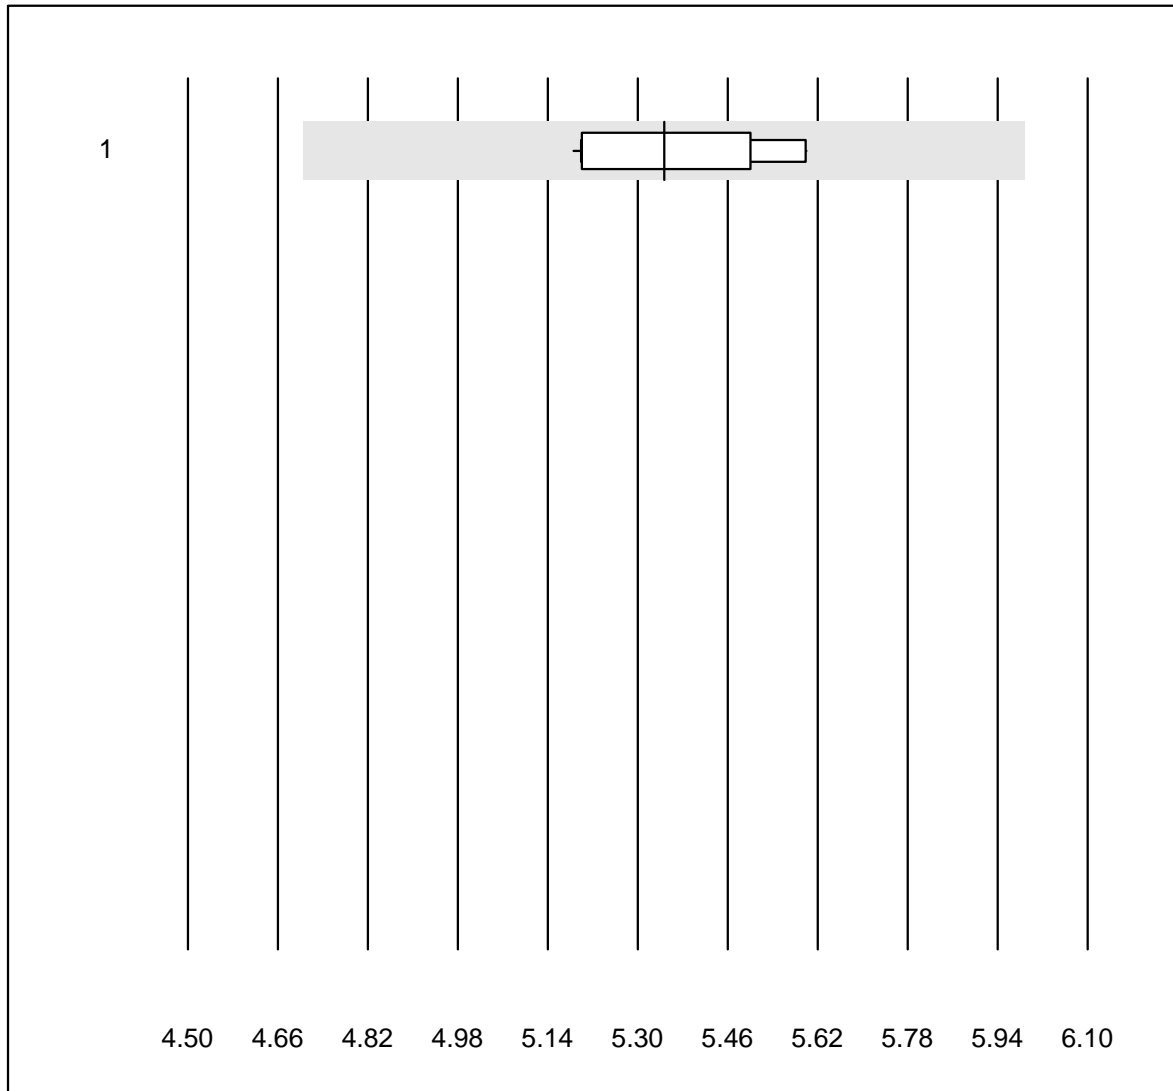


QUALAB Tolérance : 12 %

PCO2 CCA (kPa)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 OPTI CCA	12	91.7	0.0	8.3	5.35	3.0	e

## PO2 CCA

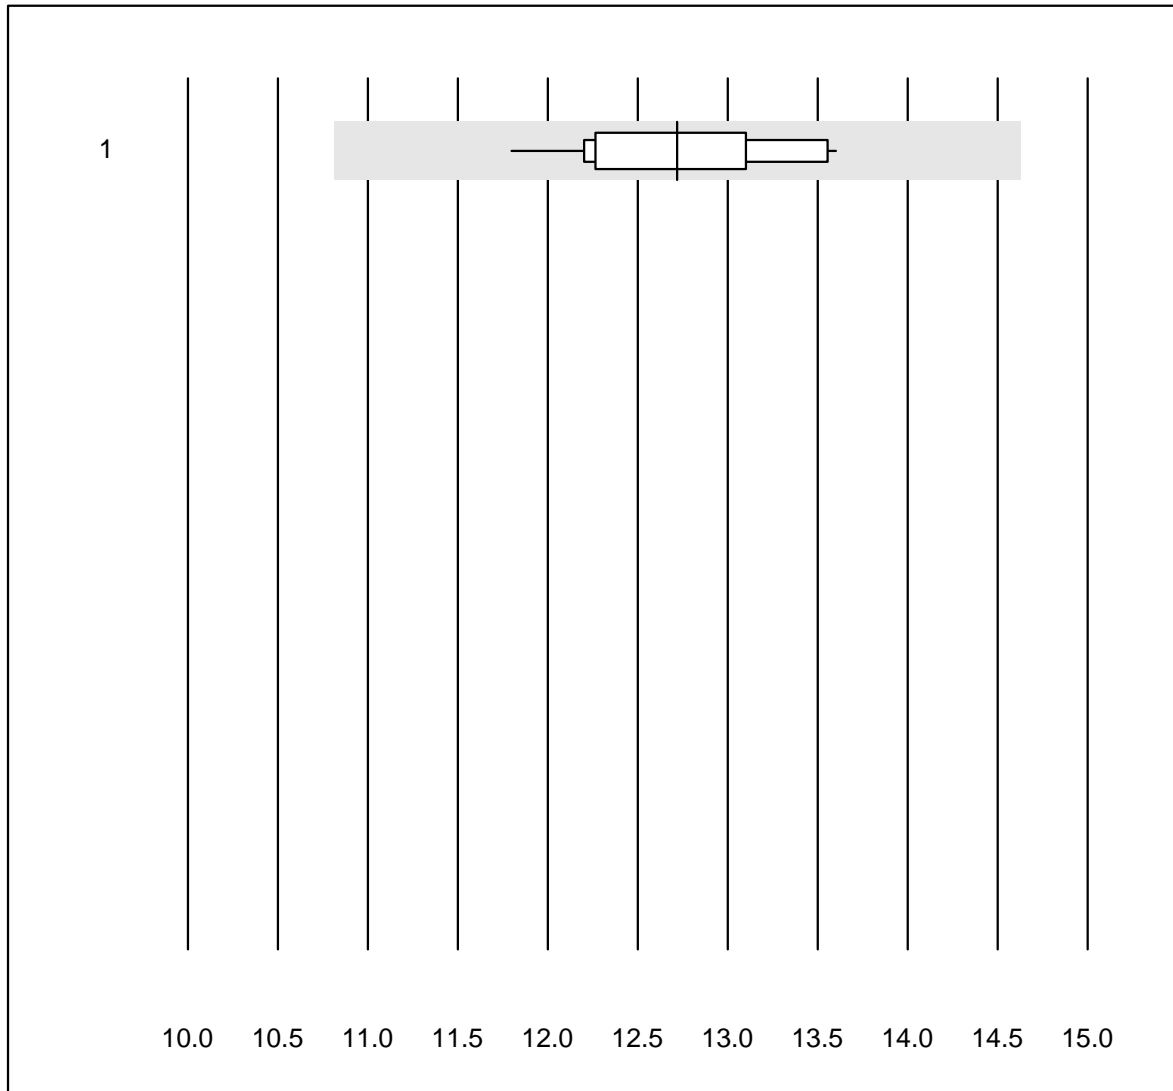


QUALAB Tolérance : 15 %

PO2 CCA (kPa)


No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 OPTI CCA	12	100.0	0.0	0.0	12.72	4.4	e

## pH CCA

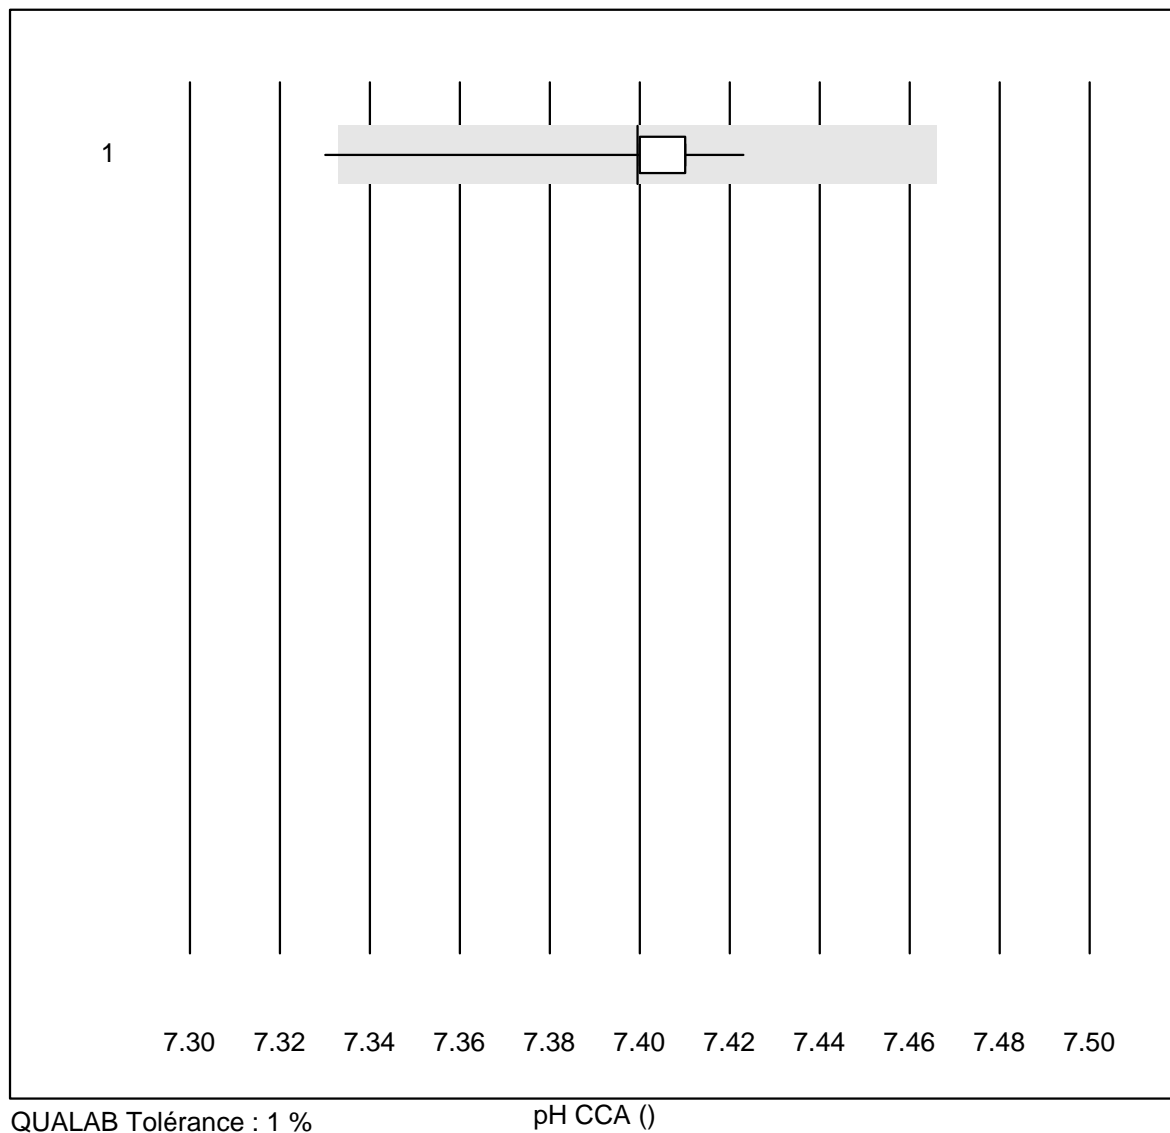

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 OPTI CCA	11	90.9	9.1	0.0	7.40	0.3	e

## Potassium CCA

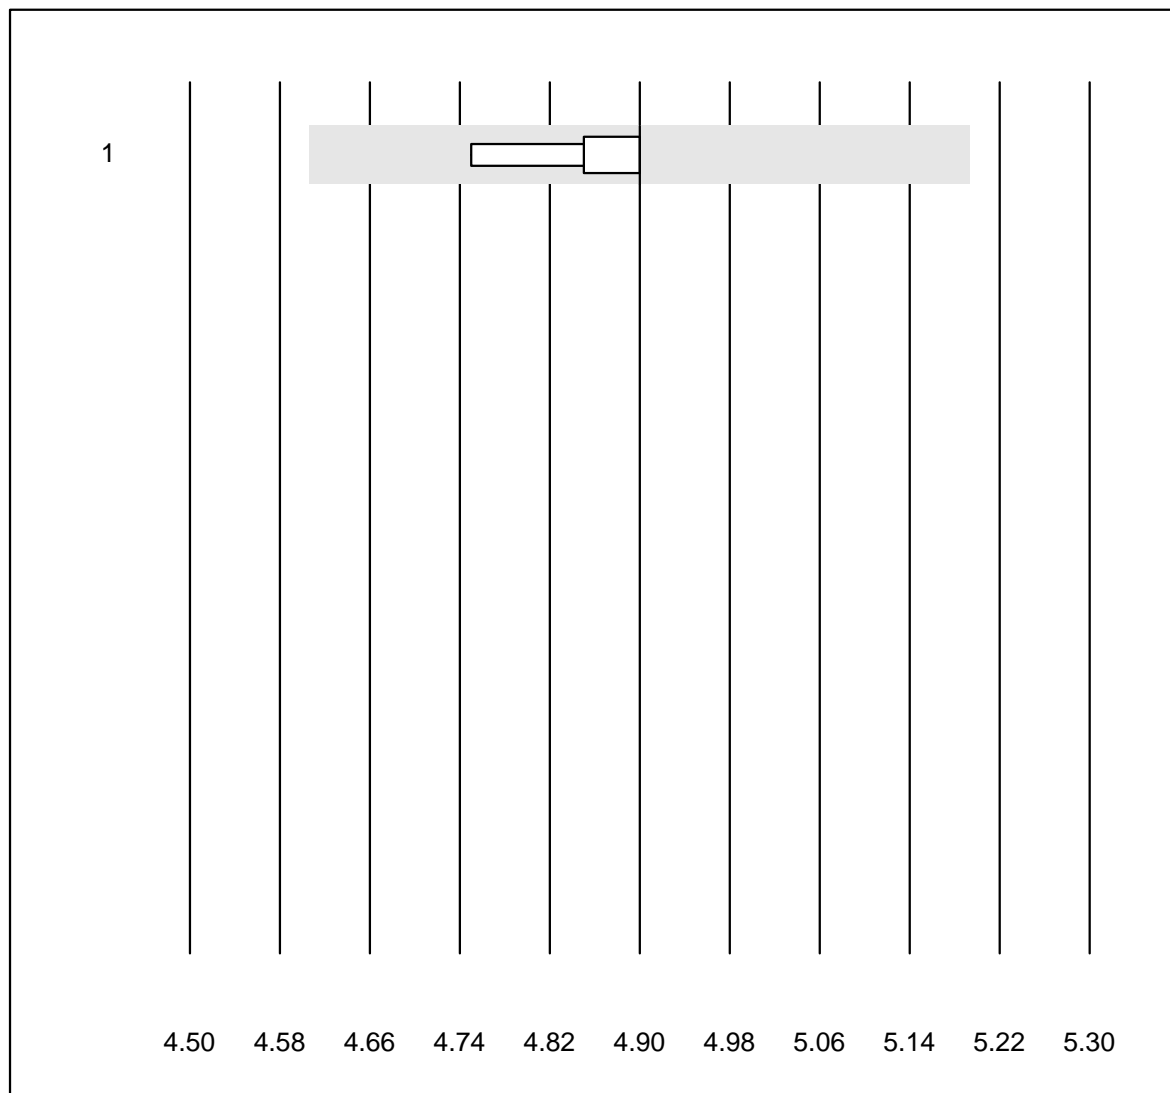


QUALAB Tolérance : 6 %

Potassium CCA (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 OPTI CCA	5	100.0	0.0	0.0	4.9	1.3	e

## Sodium CCA

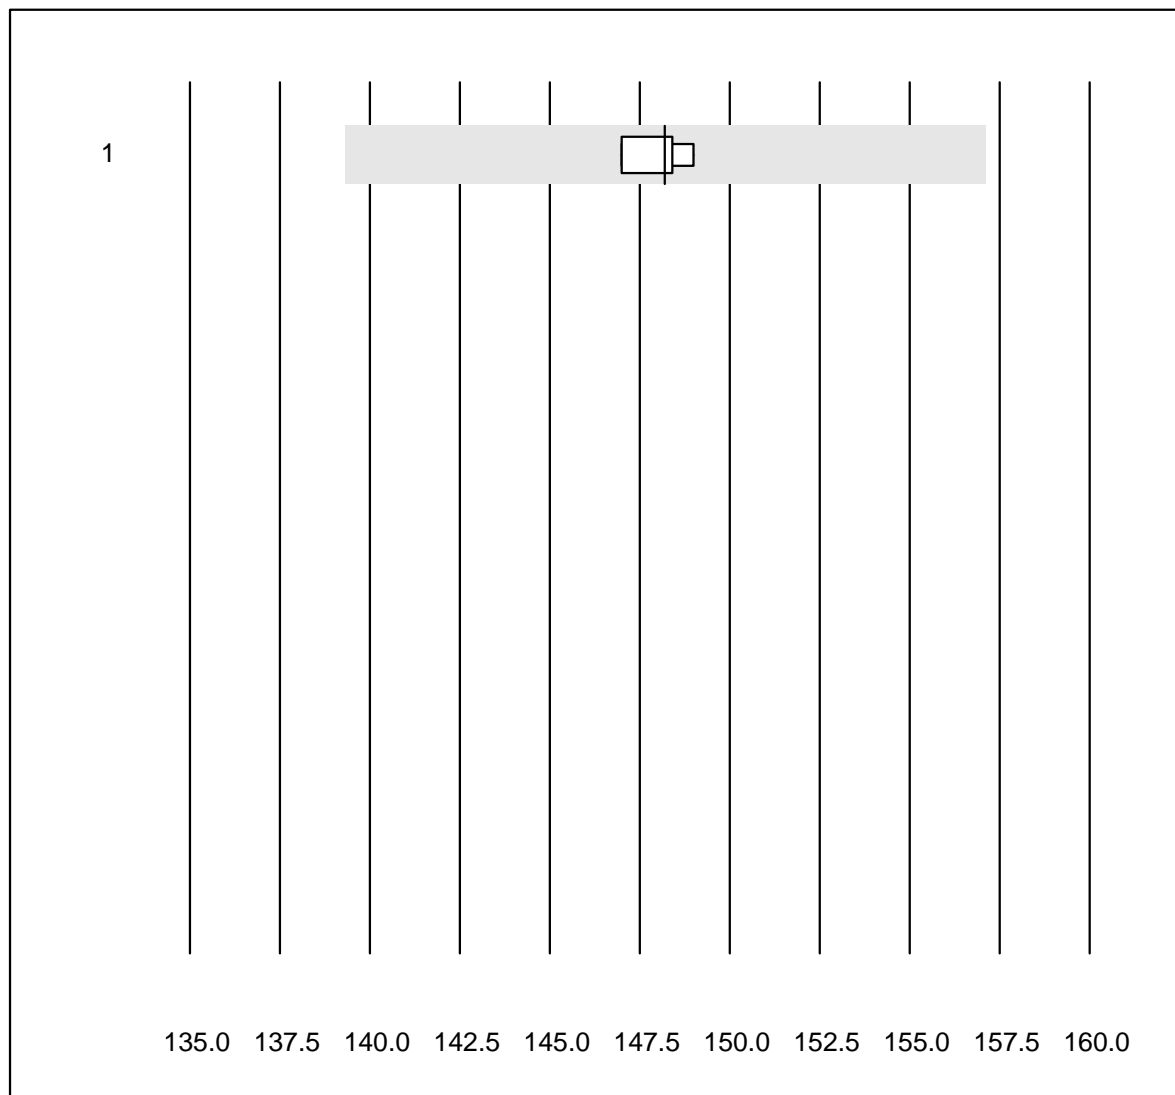


QUALAB Tolérance : 6 %

Sodium CCA (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 OPTI CCA	4	100.0	0.0	0.0	148.2	0.6	e

## Ferritine

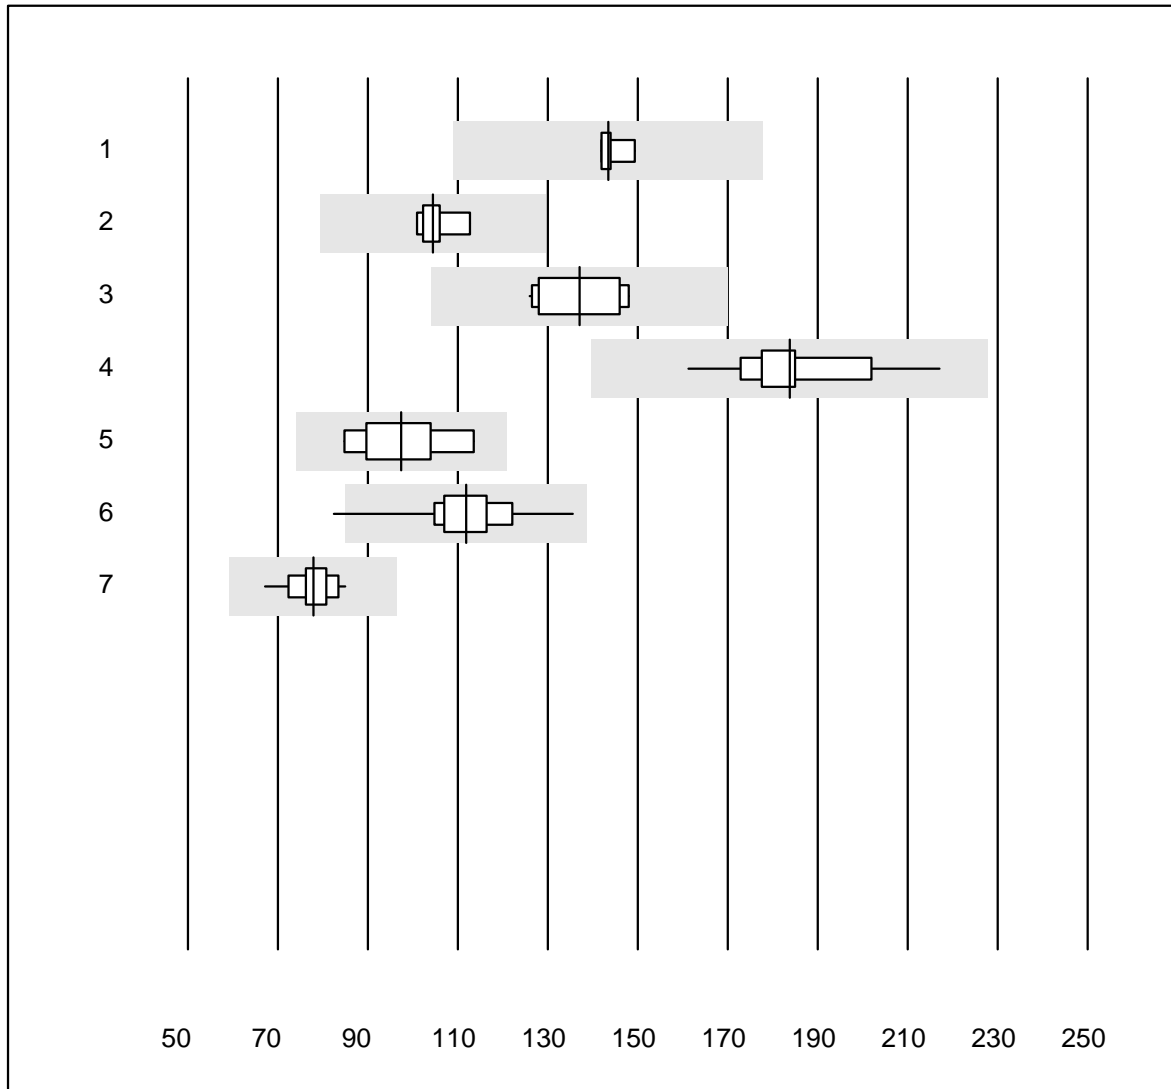


QUALAB Tolérance : 24 %

Ferritine (µg/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	Dimension	4	100.0	0.0	0.0	143.50	2.3	e
2	Beckman	6	100.0	0.0	0.0	104.45	4.0	e
3	Cobas E / Elecsys	15	100.0	0.0	0.0	137.05	6.6	e
4	Architect	12	100.0	0.0	0.0	183.77	7.7	e
5	Mini Vidas	9	100.0	0.0	0.0	97.38	10.0	e*
6	AFIAS	45	95.6	2.2	2.2	111.84	8.7	e
7	Eurolyser	18	83.3	0.0	16.7	77.87	5.6	e

## Vitamine B12

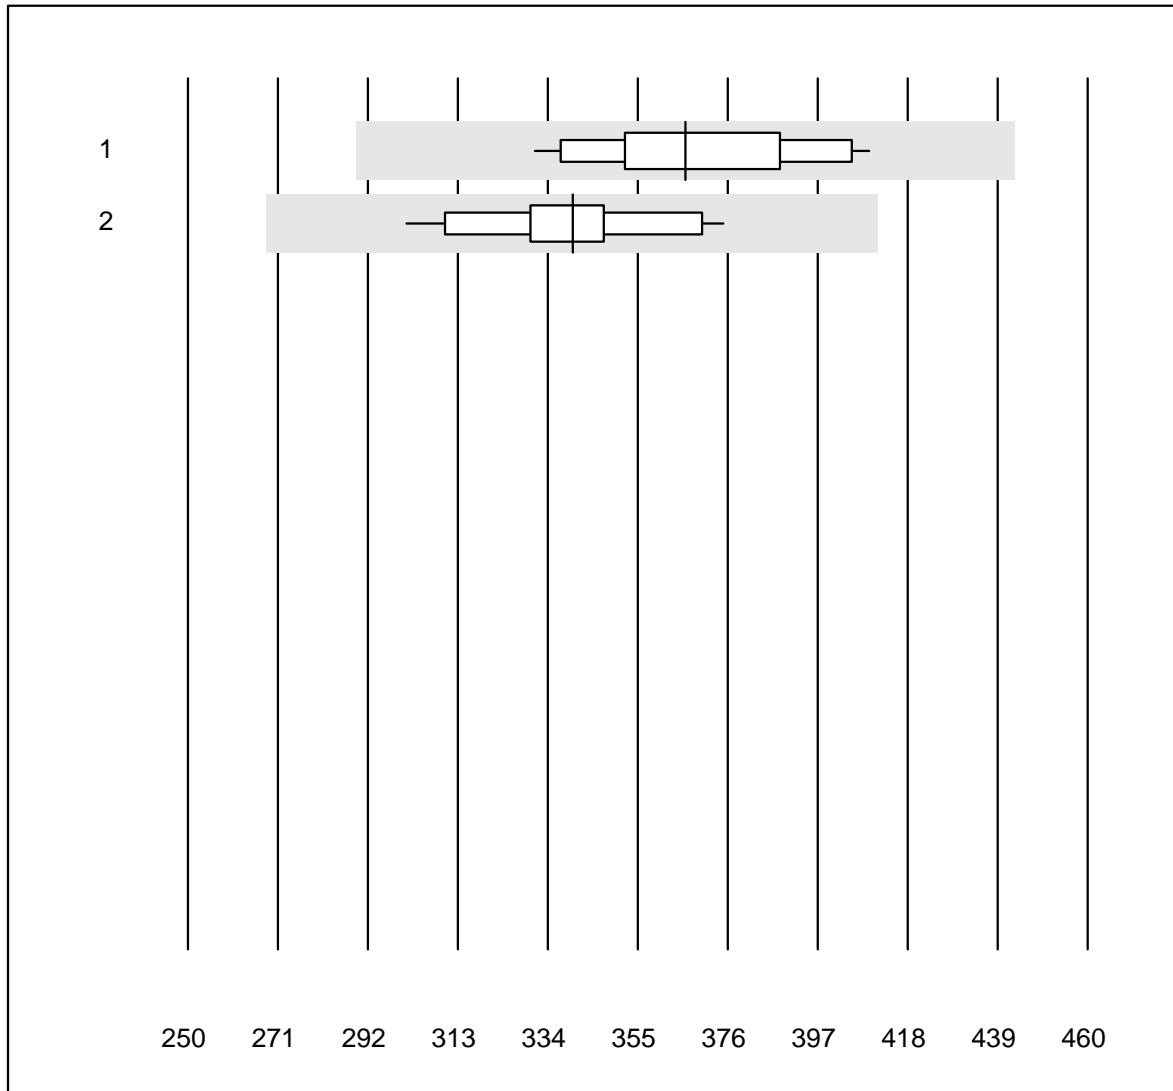


QUALAB Tolérance : 21 %

Vitamine B12 (pmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	15	100.0	0.0	0.0	366.04	6.4	e
2 Architect	12	100.0	0.0	0.0	339.79	6.5	e



## Folate

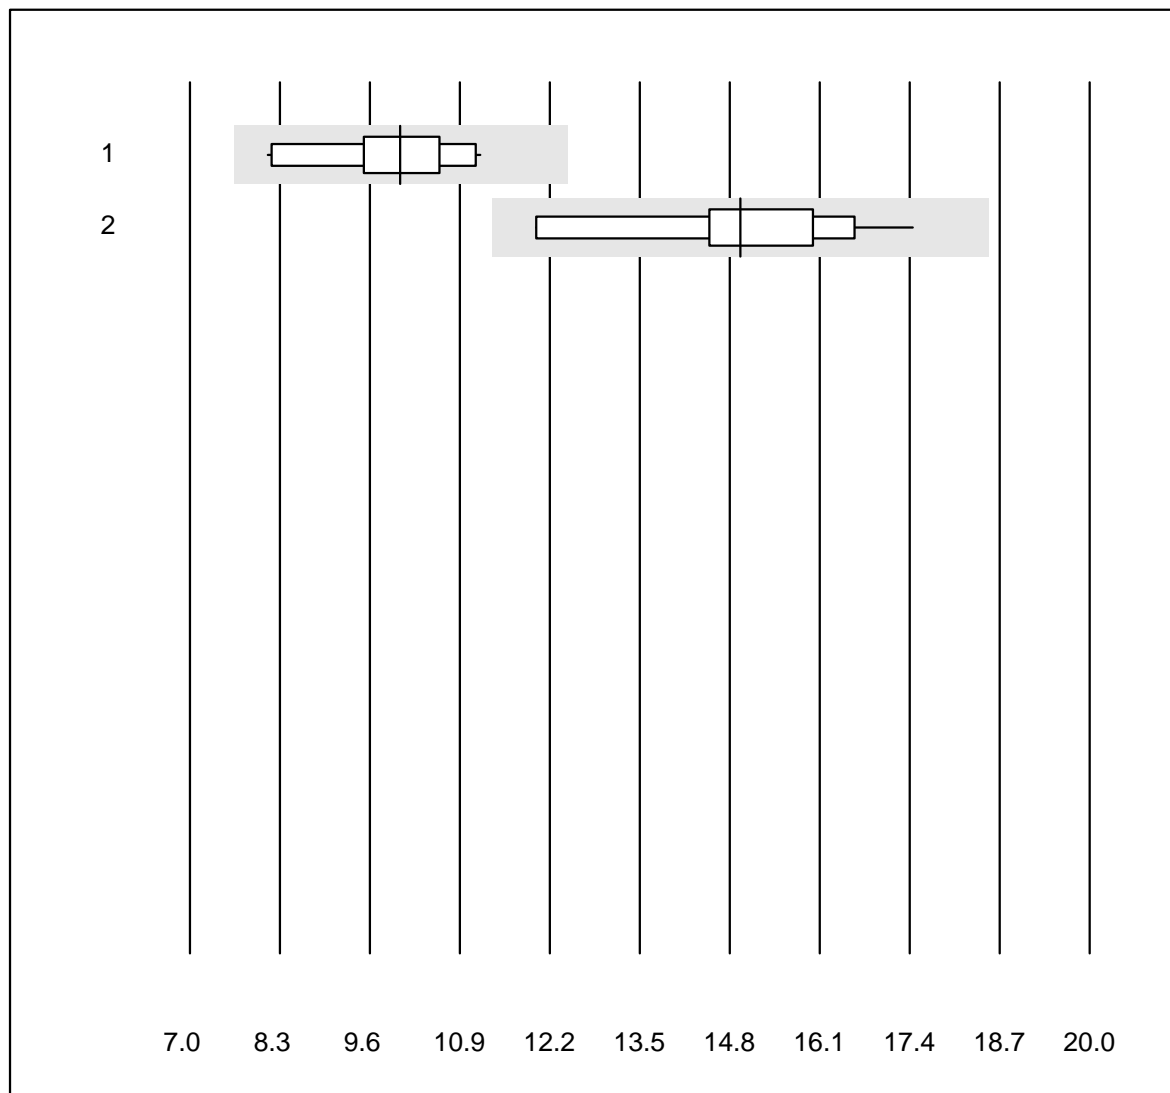


QUALAB Tolérance : 24 %

Folate (nmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	16	100.0	0.0	0.0	10.04	9.5	e
2 Architect	10	100.0	0.0	0.0	14.96	11.3	e*

## Holotranscobalamine

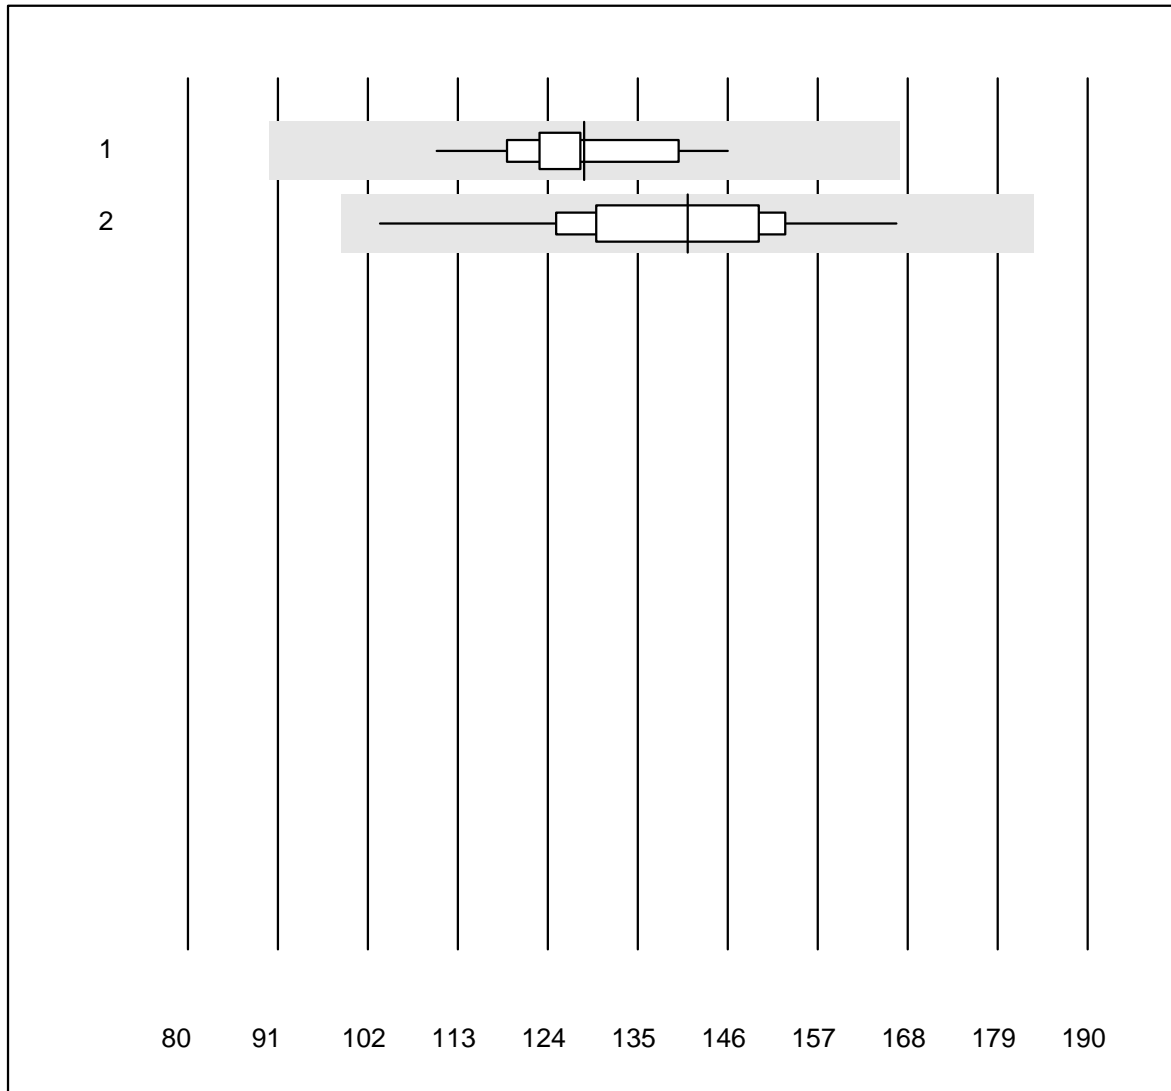


Tolérance MQ : 30 %

Holotranscobalamine (pmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Architect	12	100.0	0.0	0.0	128.4	7.4	e
2 toutes les méthodes	17	100.0	0.0	0.0	141.1	10.3	e

## Bilirubin totale Neo

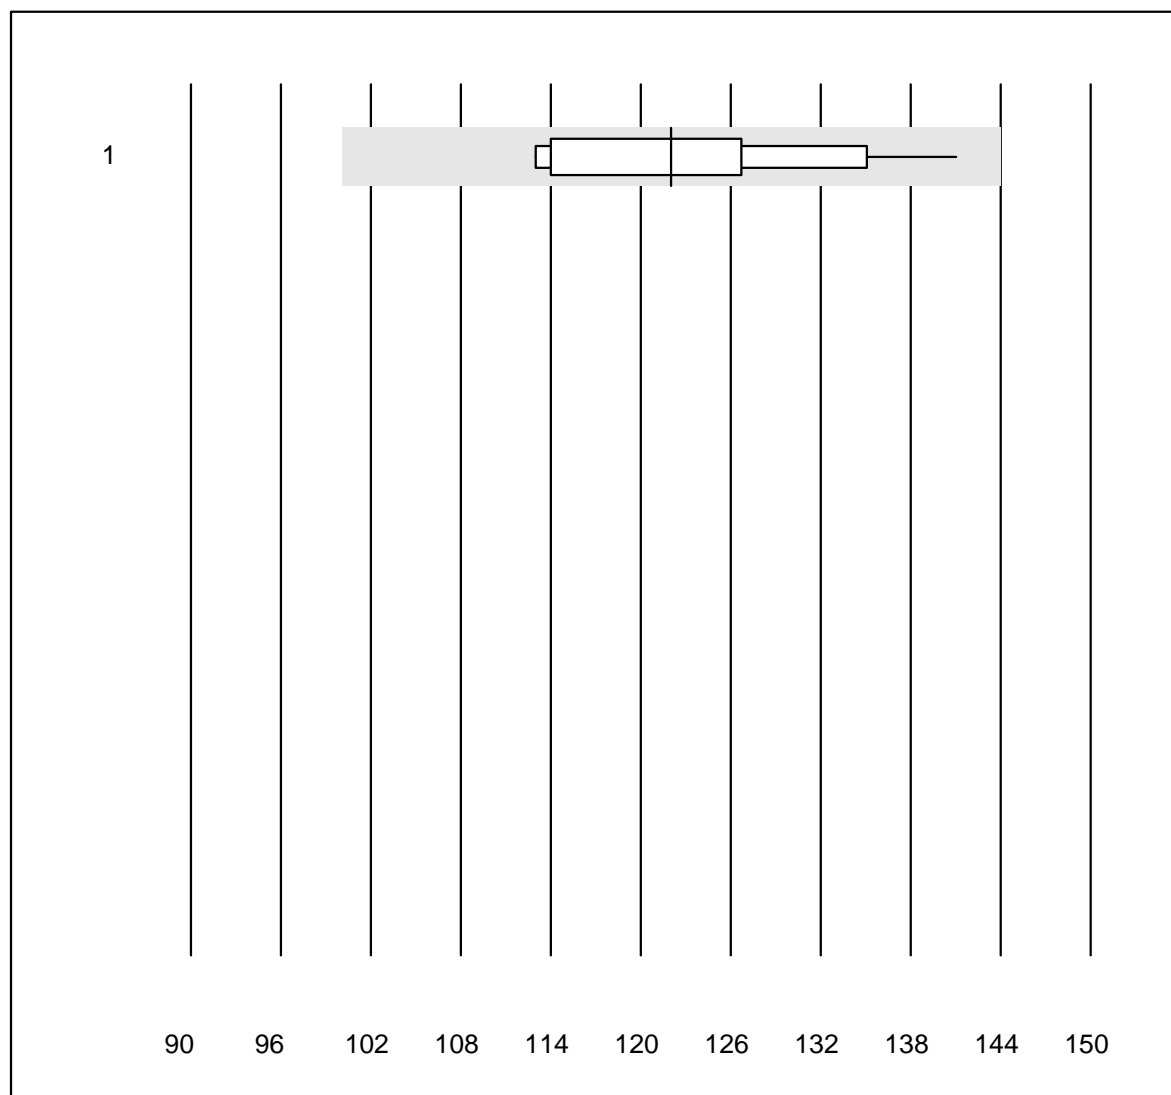


QUALAB Tolérance : 18 %

Bilirubin totale Neo ( $\mu\text{mol/l}$ )

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	13	100.0	0.0	0.0	122	7.3	e

## Bilirubin directe

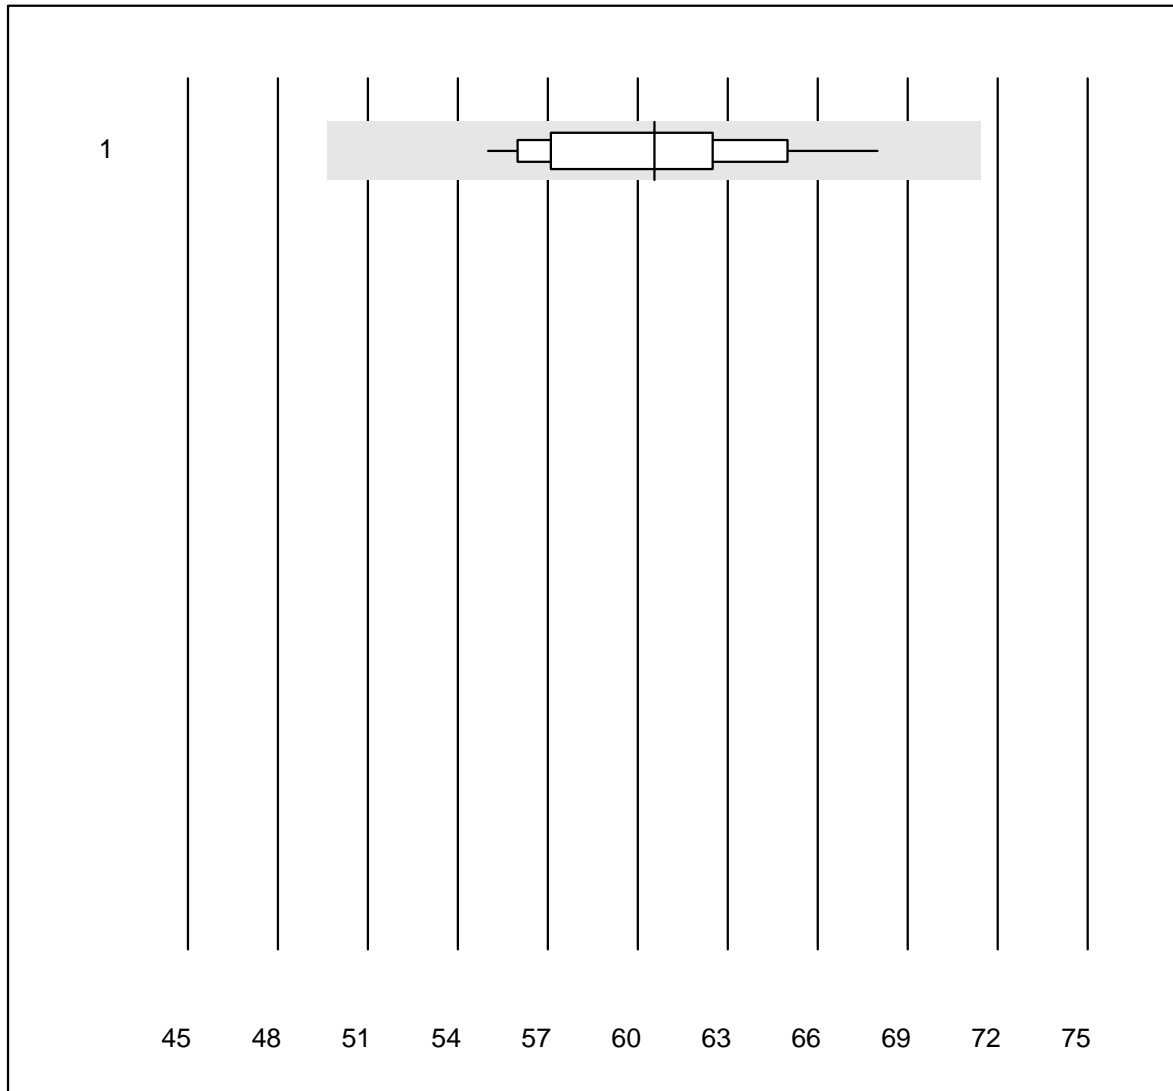


QUALAB Tolérance : 18 %

Bilirubin directe (µmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	14	100.0	0.0	0.0	61	6.0	e

## Bilirubin néonatale

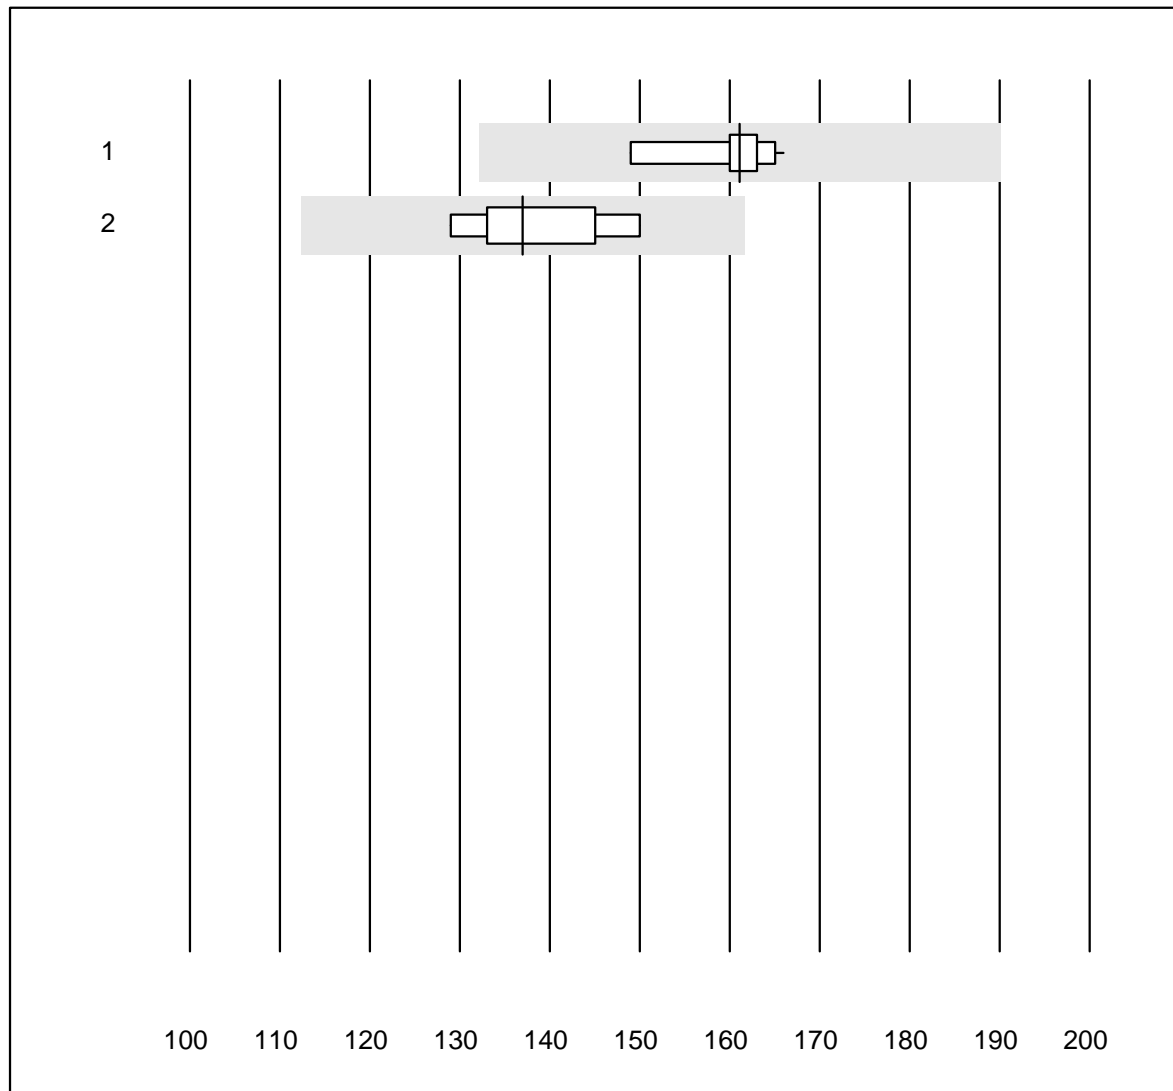


QUALAB Tolérance : 18 %

Bilirubin néonatale (μmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	10	100.0	0.0	0.0	161	3.0	e
2 ABL700/800	9	100.0	0.0	0.0	137	5.3	e

## PSA

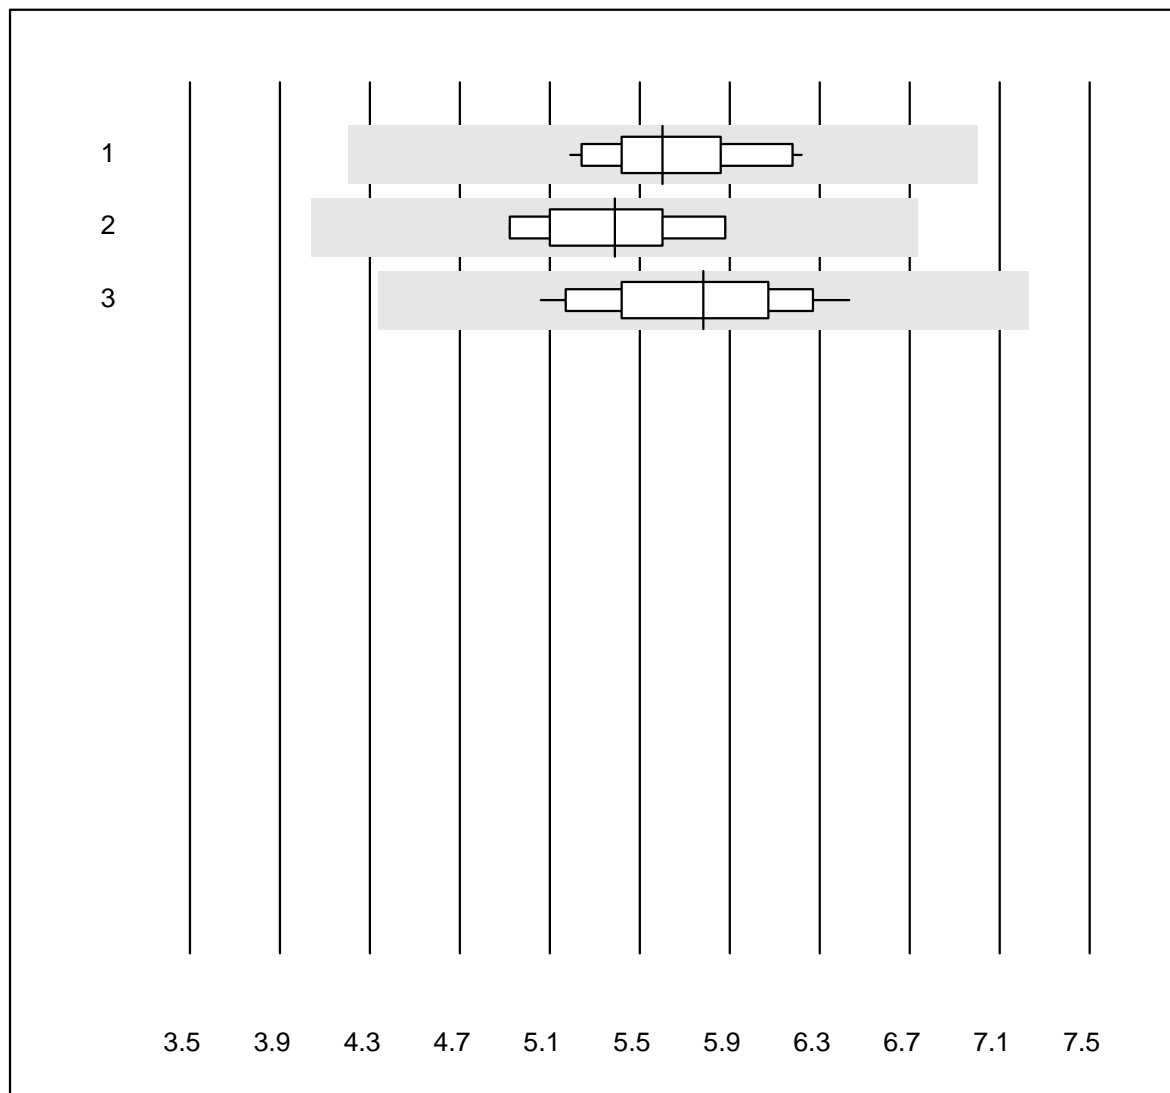


QUALAB Tolérance : 25 %

PSA (µg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	15	100.0	0.0	0.0	5.60	5.6	e
2 Architect	7	100.0	0.0	0.0	5.39	6.1	e
3 AFIAS	29	100.0	0.0	0.0	5.78	6.9	e

## PSA frei

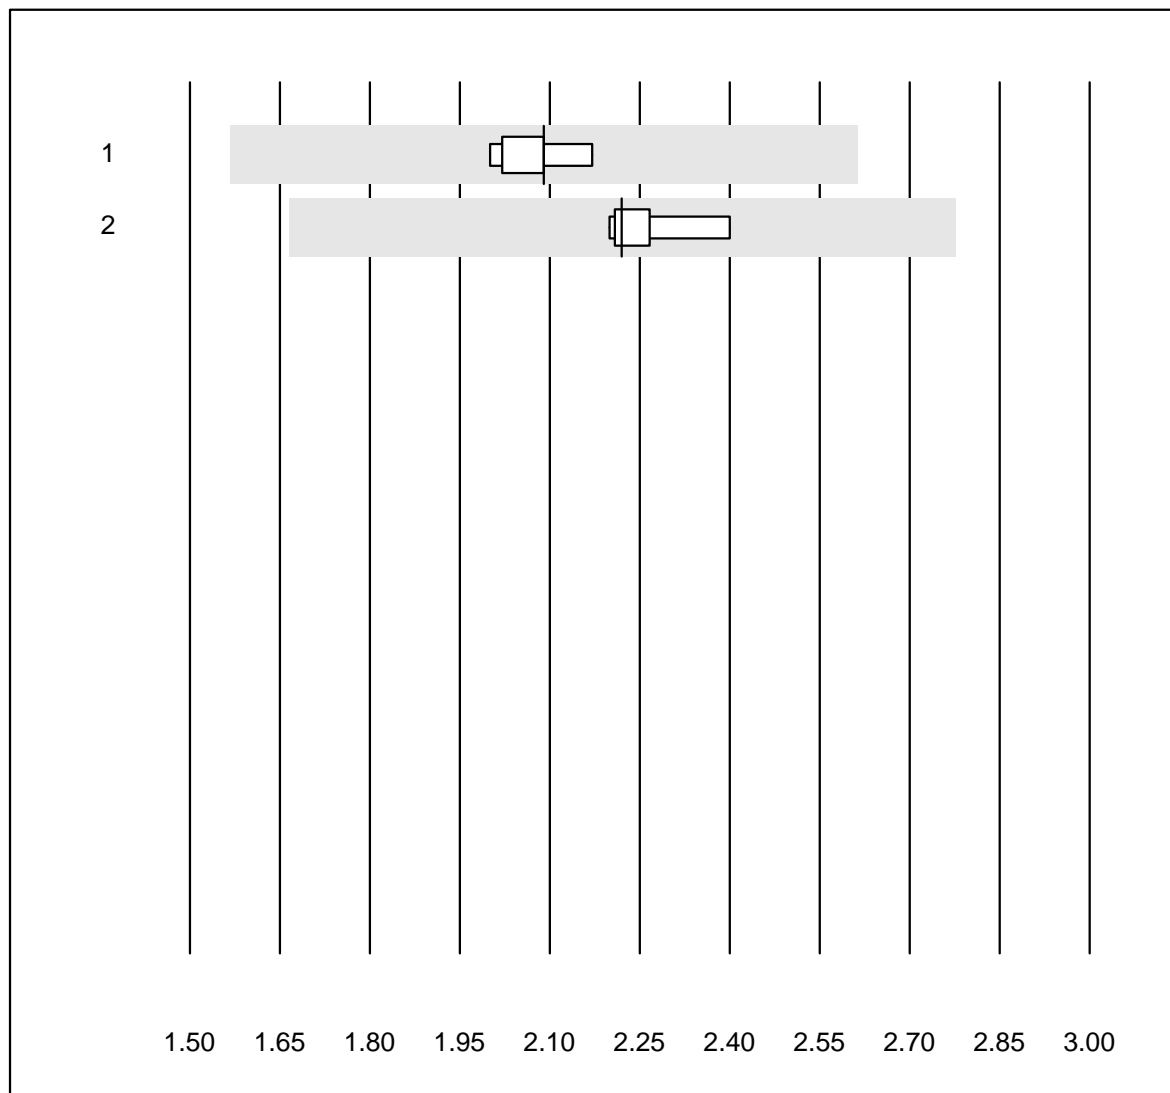


QUALAB Tolérance : 25 %

PSA frei (µg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	8	100.0	0.0	0.0	2.09	2.7	e
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	2.22	3.7	e


# CEA

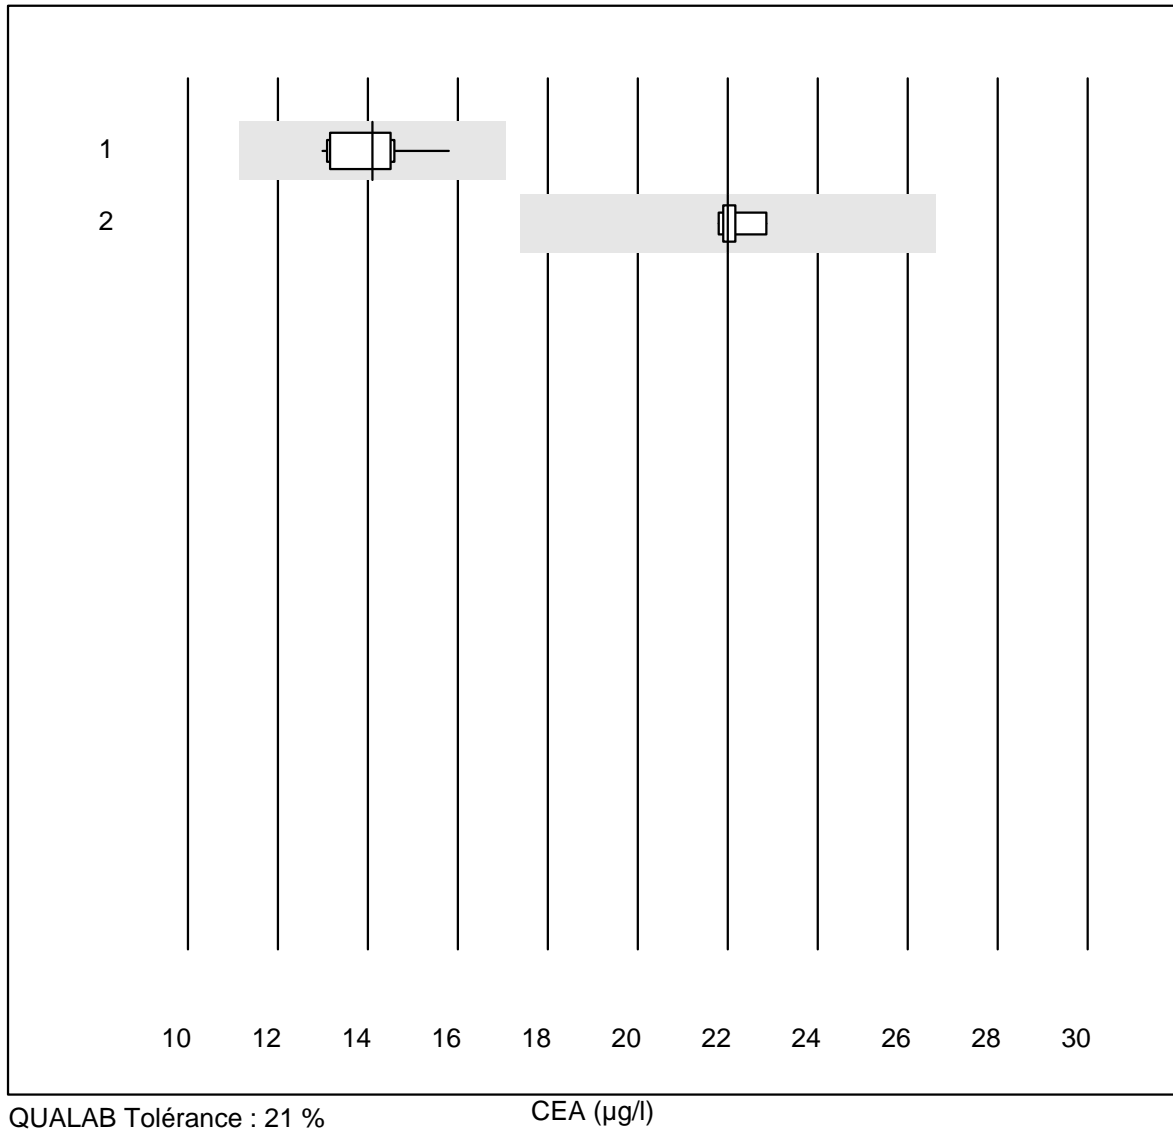

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	11	100.0	0.0	0.0	14.1	5.8	e
2 Architect	6	100.0	0.0	0.0	22.0	1.7	e



# CA 125

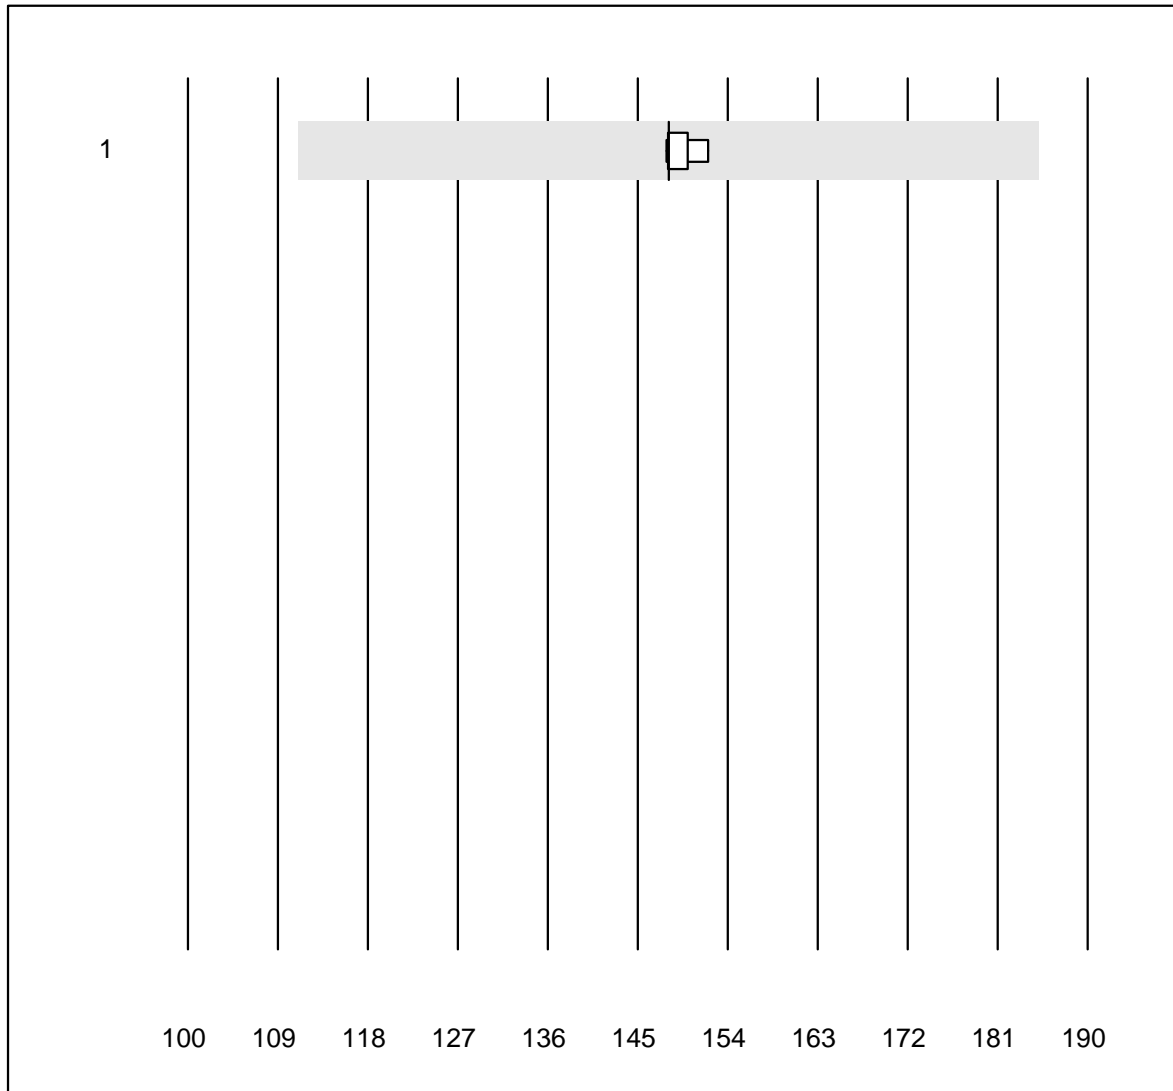

Tolérance MQ : 25 %

CA 125 (kIU/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	6	100.0	0.0	0.0	148.1	1.1	e

## CA 19-9




Tolérance MQ : 25 %

CA 19-9 (kIU/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	5	100.0	0.0	0.0	28.7	14.5	a

## CA 15-3

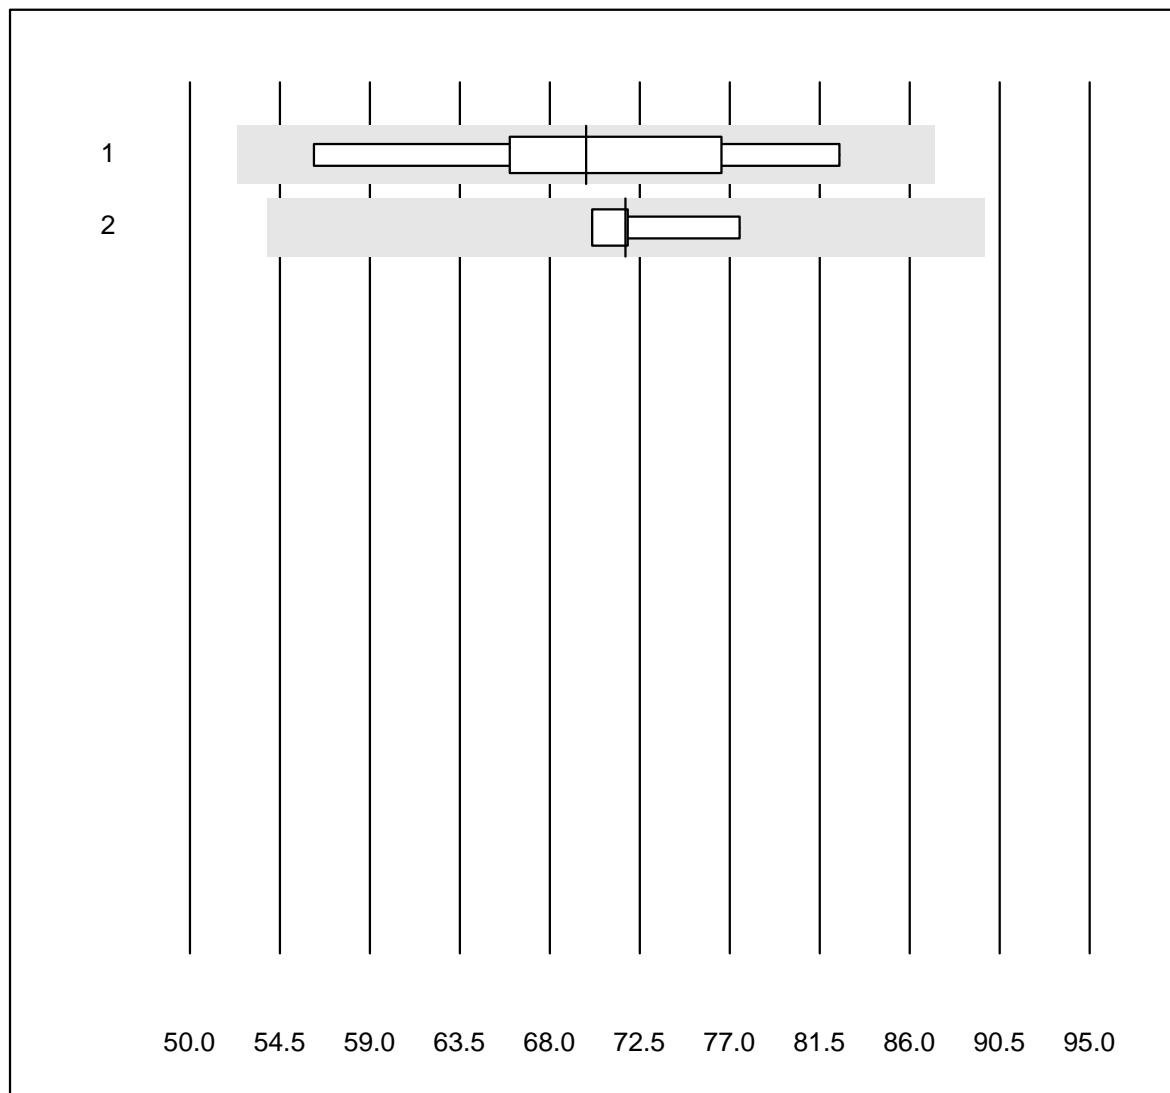


Tolérance MQ : 25 %

CA 15-3 (kIU/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	7	100.0	0.0	0.0	69.8	12.0	a
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	71.8	4.4	e

# AFP

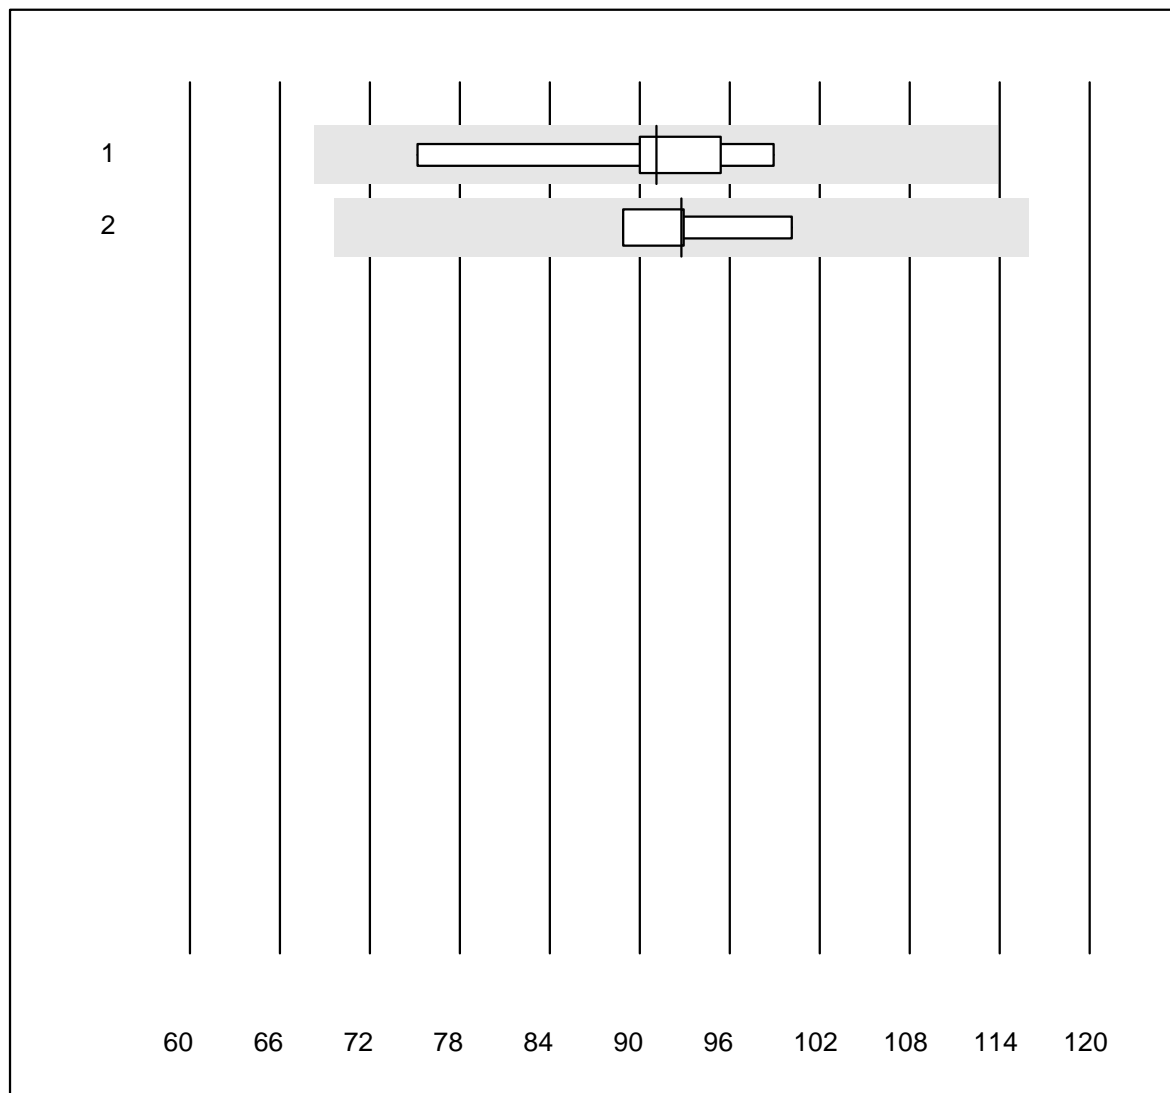


QUALAB Tolérance : 25 %

AFP (µg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	6	100.0	0.0	0.0	91.1	9.0	e*
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	92.8	5.0	e

## HCG qn

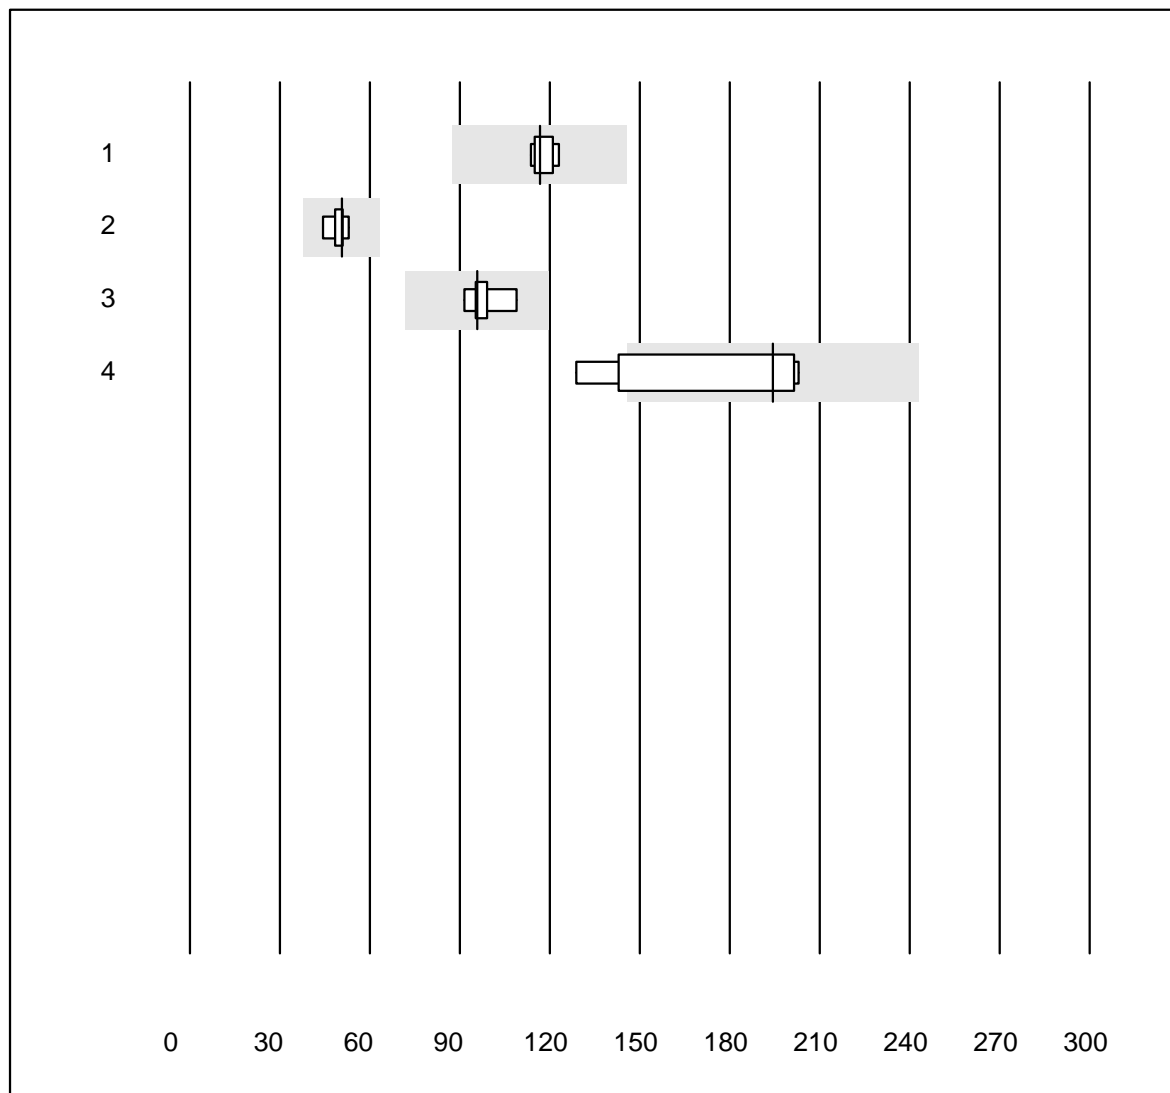


QUALAB Tolérance : 25 %

HCG qn (U/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	7	100.0	0.0	0.0	116.7	2.8	e
2 VIDAS	8	100.0	0.0	0.0	50.6	5.4	e
3 Architect	6	83.3	0.0	16.7	95.7	6.7	e
4 AFIAS	7	71.4	28.6	0.0	194.4	16.9	e*

## HCG intakt

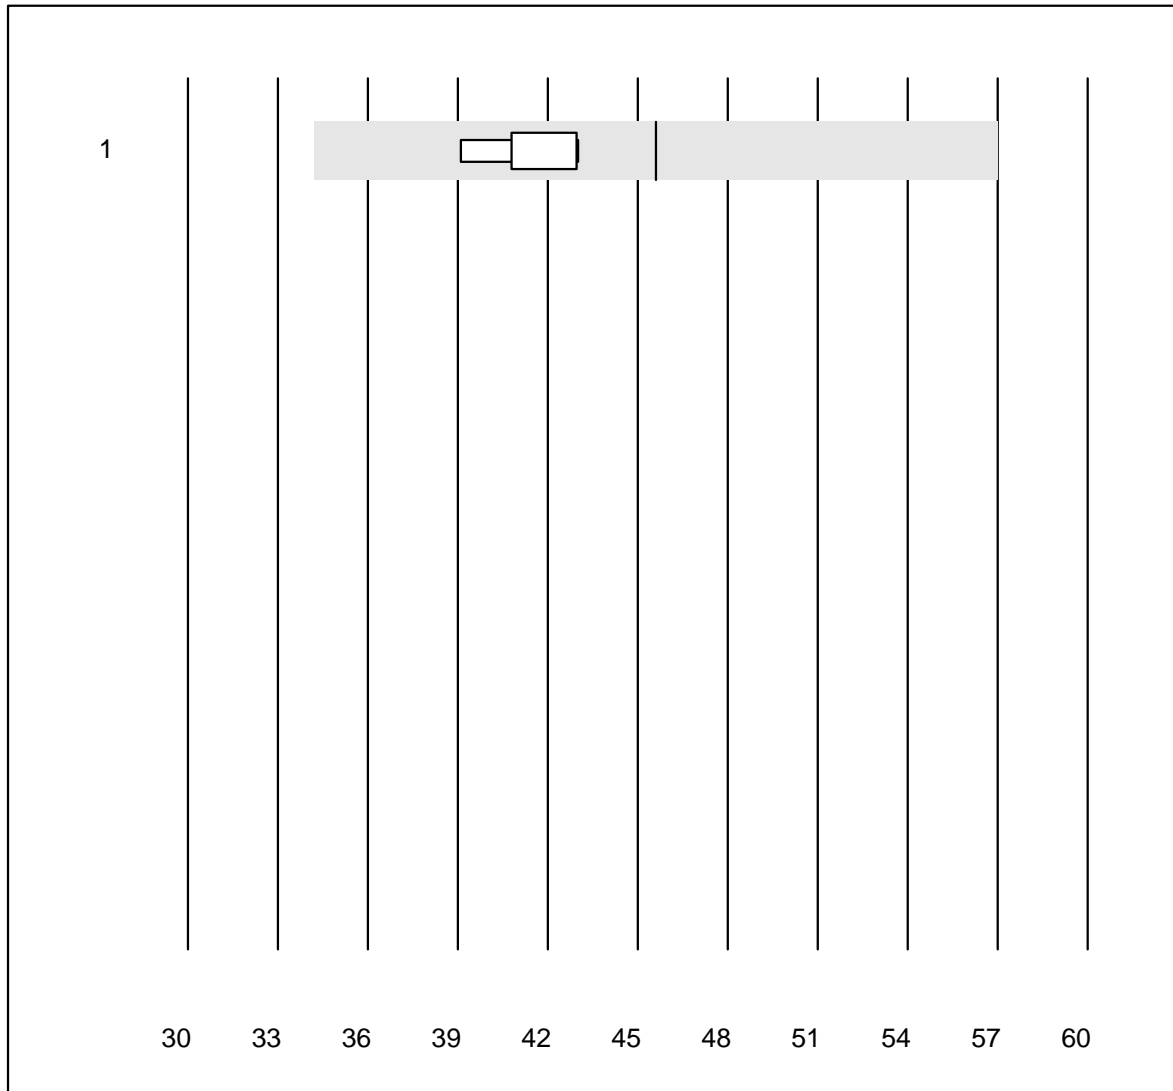


QUALAB Tolérance : 25 %

HCG intakt (U/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	45.6	4.0	a

# Thyreoglobuline

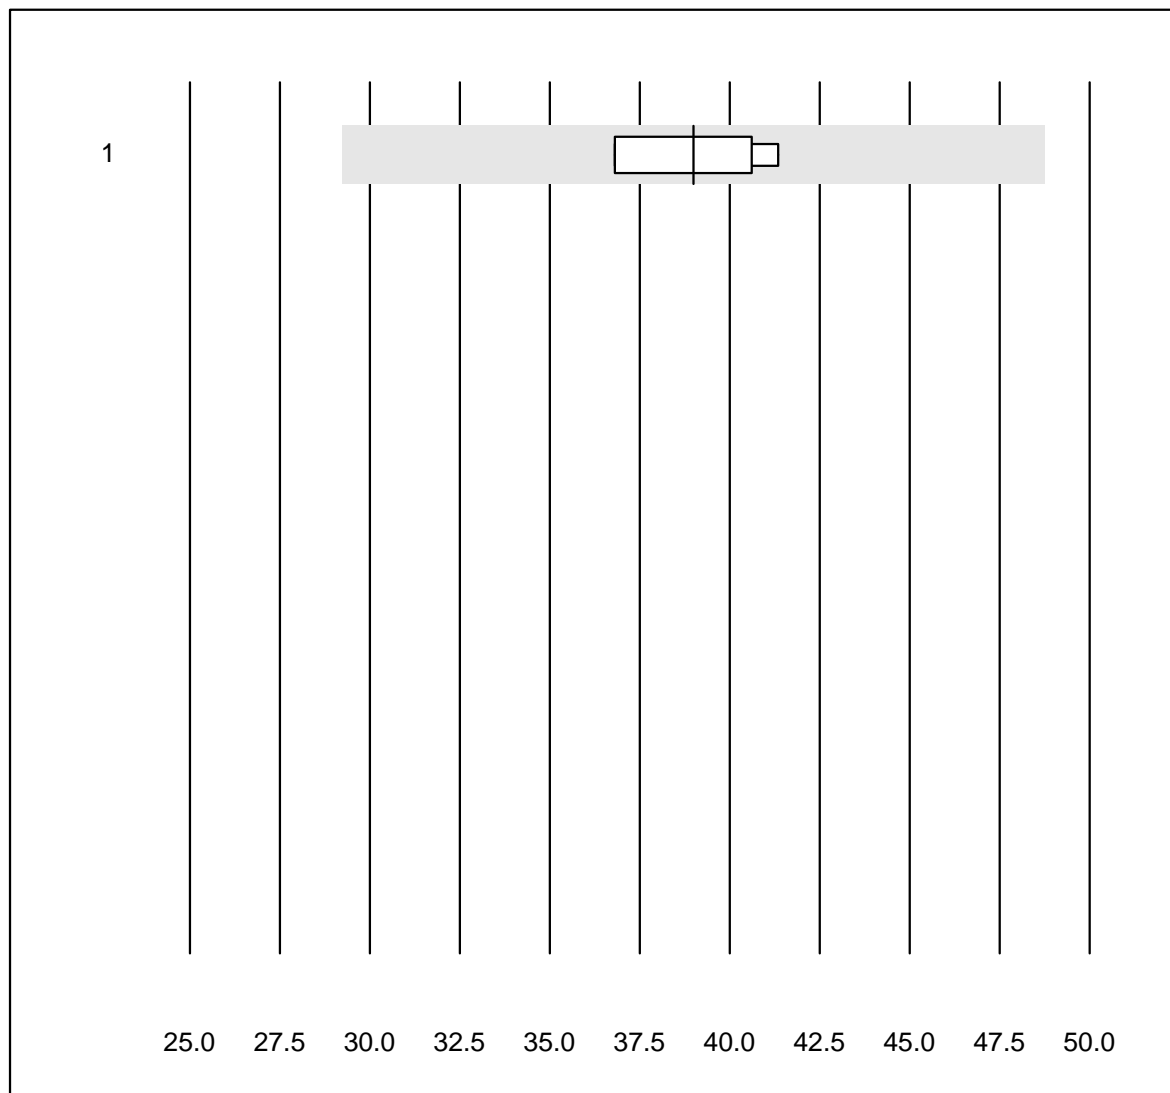


Tolérance MQ : 25 %

Thyreoglobuline (µg/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	39.0	5.8	e

## CK-MB

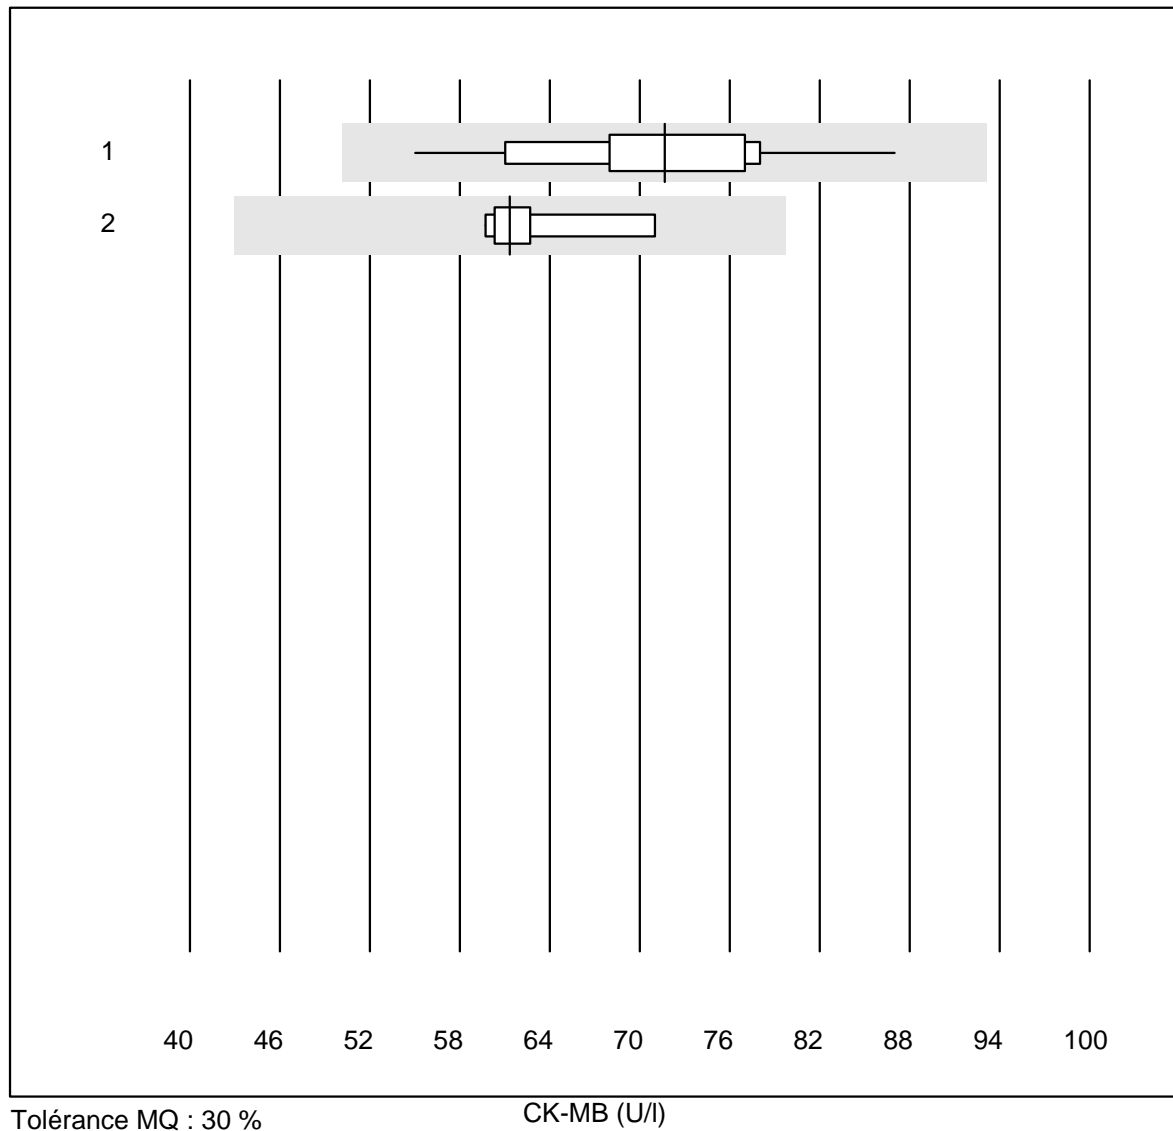


Tolérance MQ : 30 %

CK-MB (U/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Fuji Dri-Chem	31	96.8	0.0	3.2	71.7	9.7	e
2 Cobas/Roche	6	100.0	0.0	0.0	61.4	6.7	e



## Cholestérol PTS

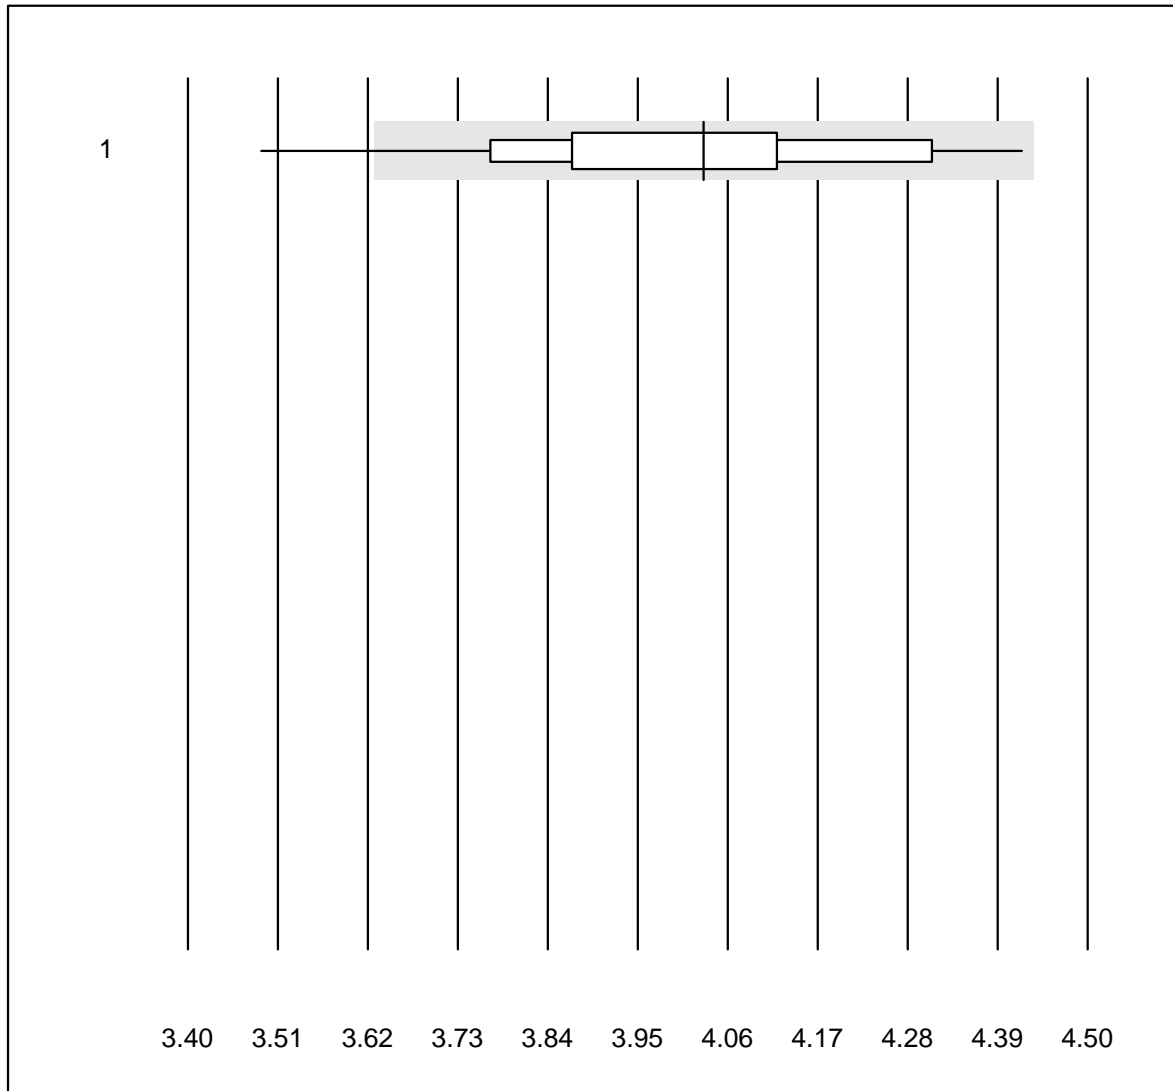


QUALAB Tolérance : 10 %

Cholestérol PTS (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 CardioChek	13	84.6	7.7	7.7	4.03	6.4	e*


## Cholestérol HDL PTS

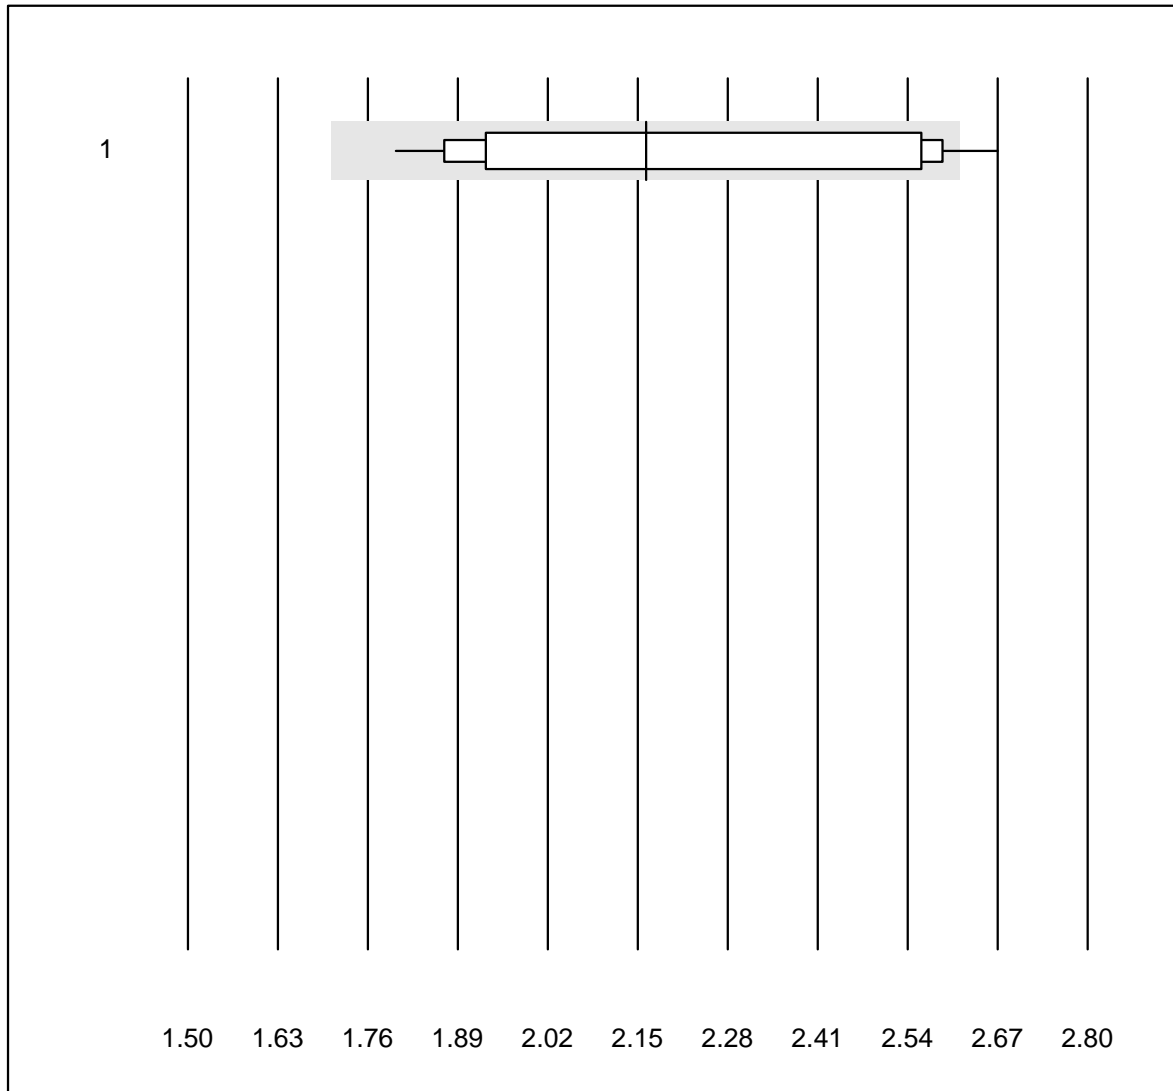

QUALAB Tolérance : 21 % Cholestérol HDL PTS (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 CardioChek	13	76.9	7.7	15.4	2.16	14.4	e*

## Triglycérides PTS

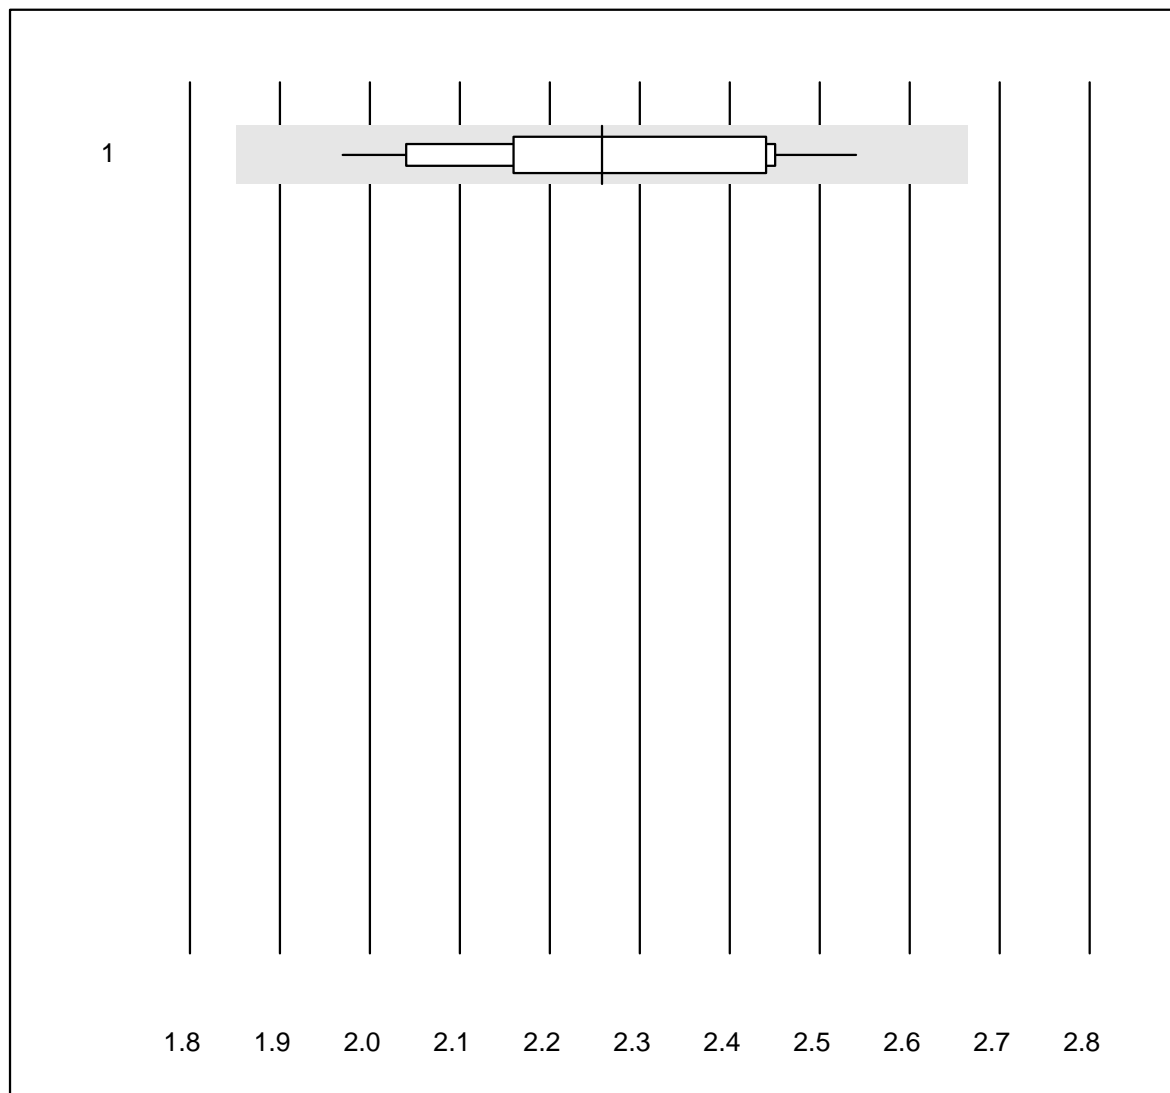


QUALAB Tolérance : 18 %

Triglycérides PTS (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 CardioChek	13	100.0	0.0	0.0	2.26	7.7	e

## C-Peptid

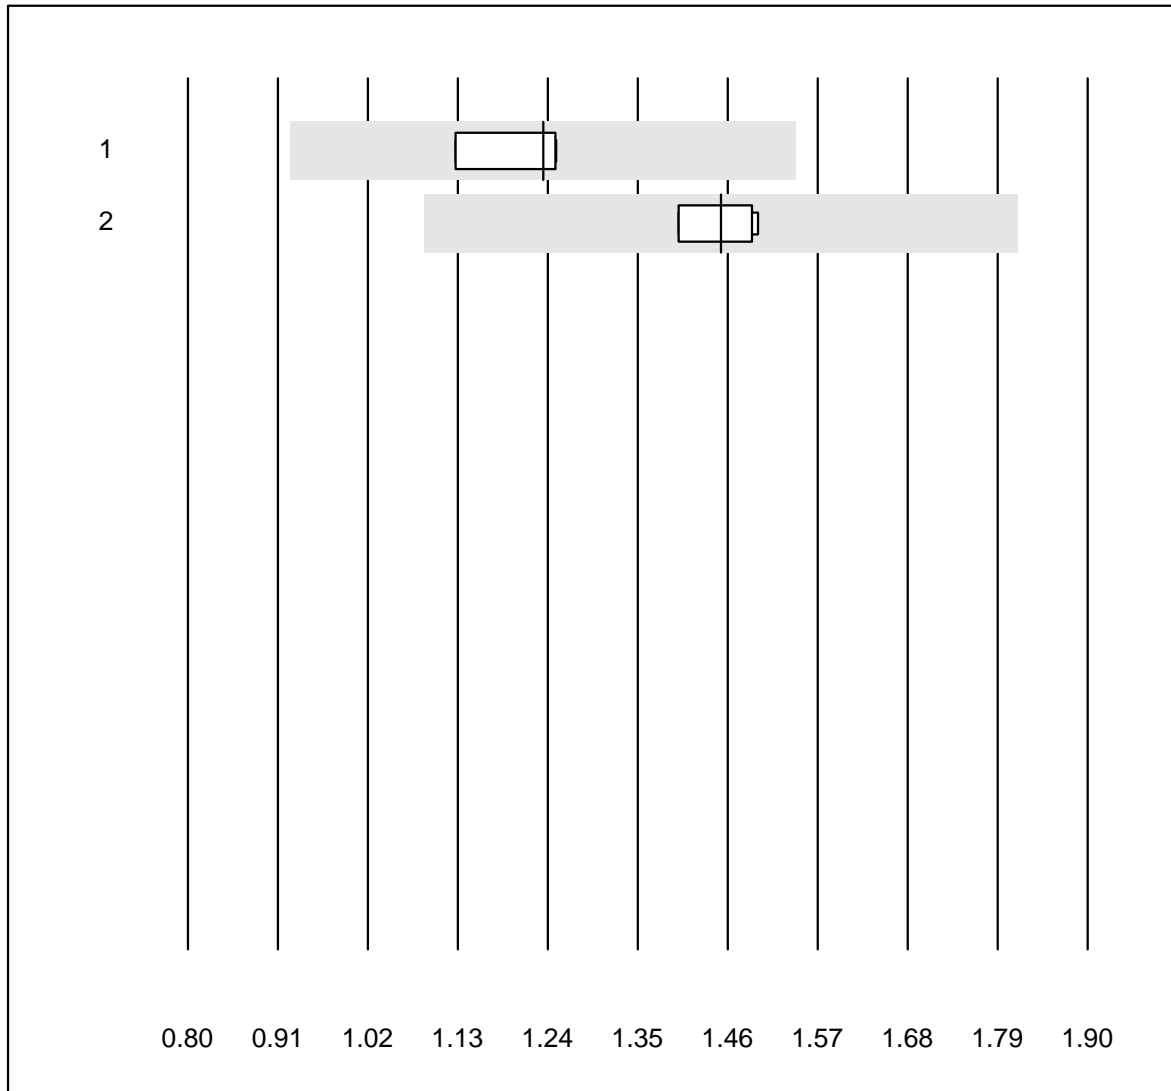


Tolérance MQ : 25 %

C-Peptid (nmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	1.23	4.8	e
2 Liaison	4	100.0	0.0	0.0	1.45	3.5	e

# ACTH

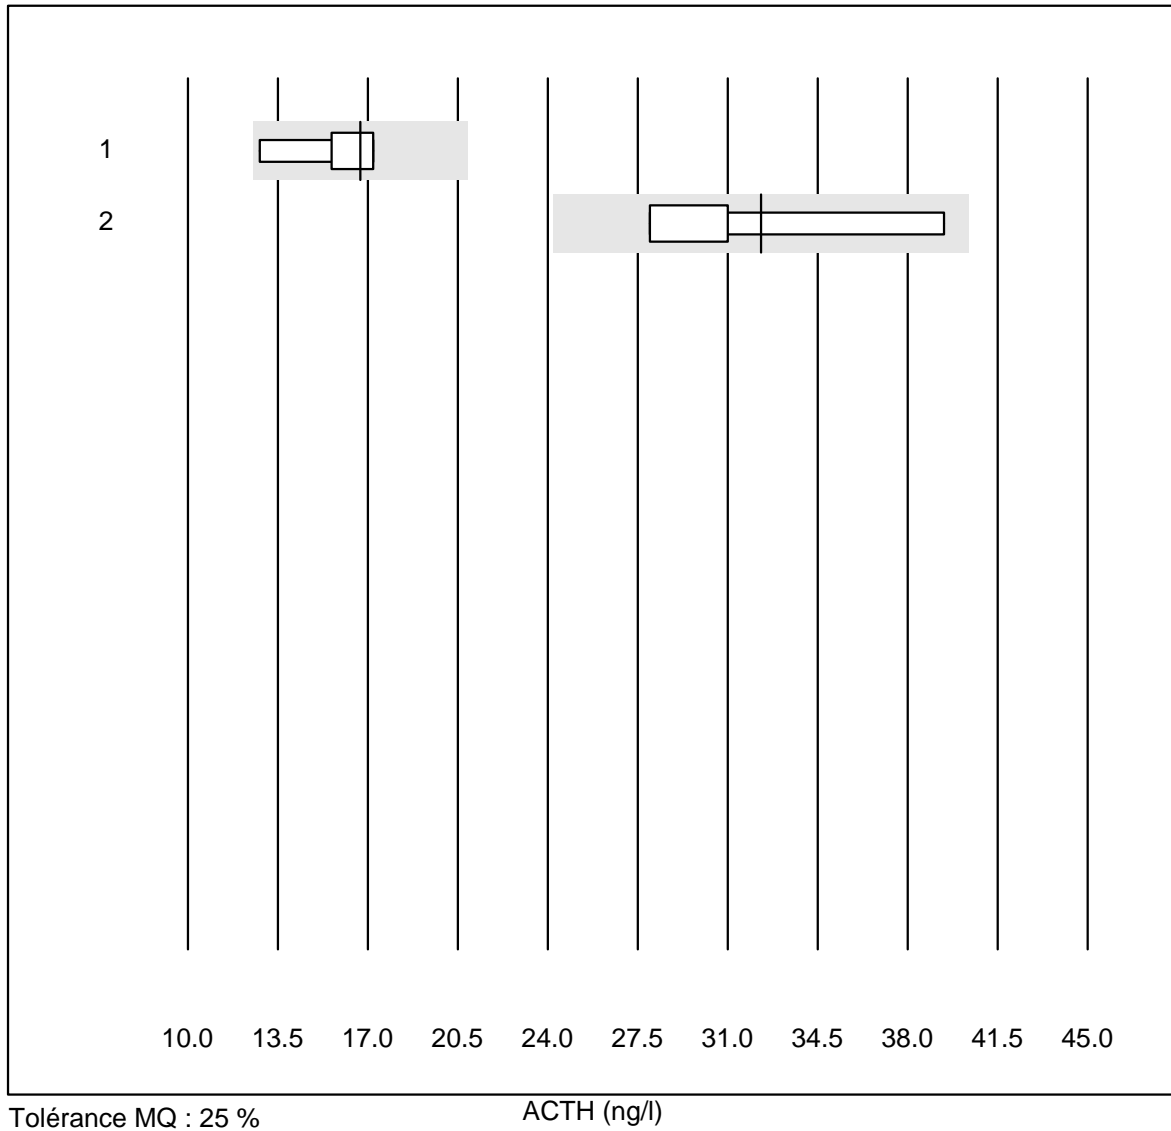


Tolérance MQ : 25 %

ACTH (ng/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	16.70	11.6	e*
2 Liaison	4	100.0	0.0	0.0	32.30	15.9	a

## Procalcitonine

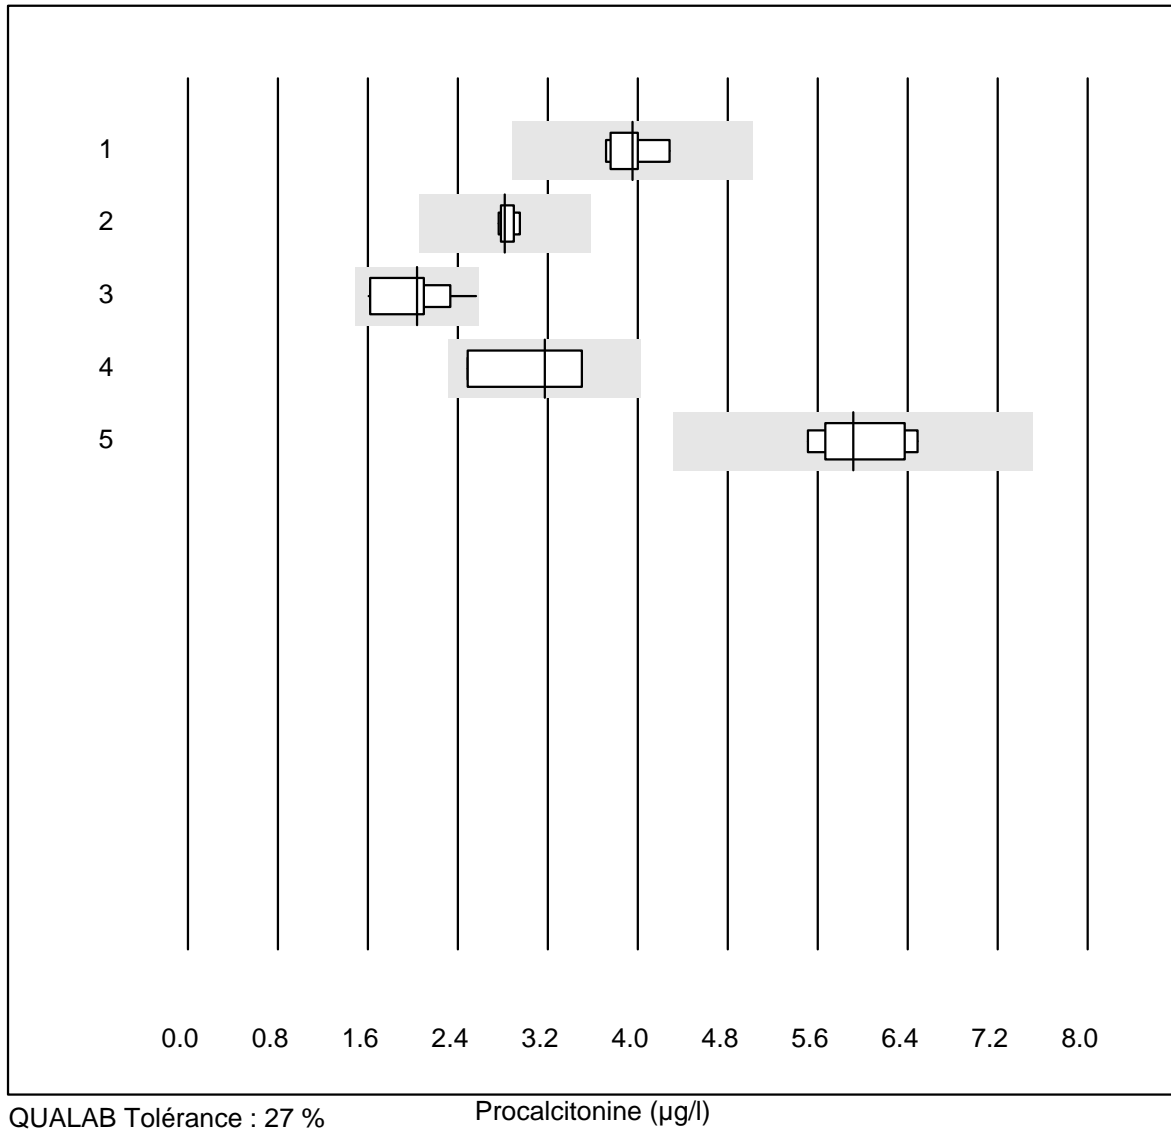

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Architect	6	100.0	0.0	0.0	3.96	5.1	e
2 Cobas	9	100.0	0.0	0.0	2.82	2.4	e
3 VIDAS	11	100.0	0.0	0.0	2.04	16.1	e*
4 Autres méthodes	4	75.0	0.0	25.0	3.17	17.4	e*
5 Liaison	6	100.0	0.0	0.0	5.92	6.9	e

# EPO

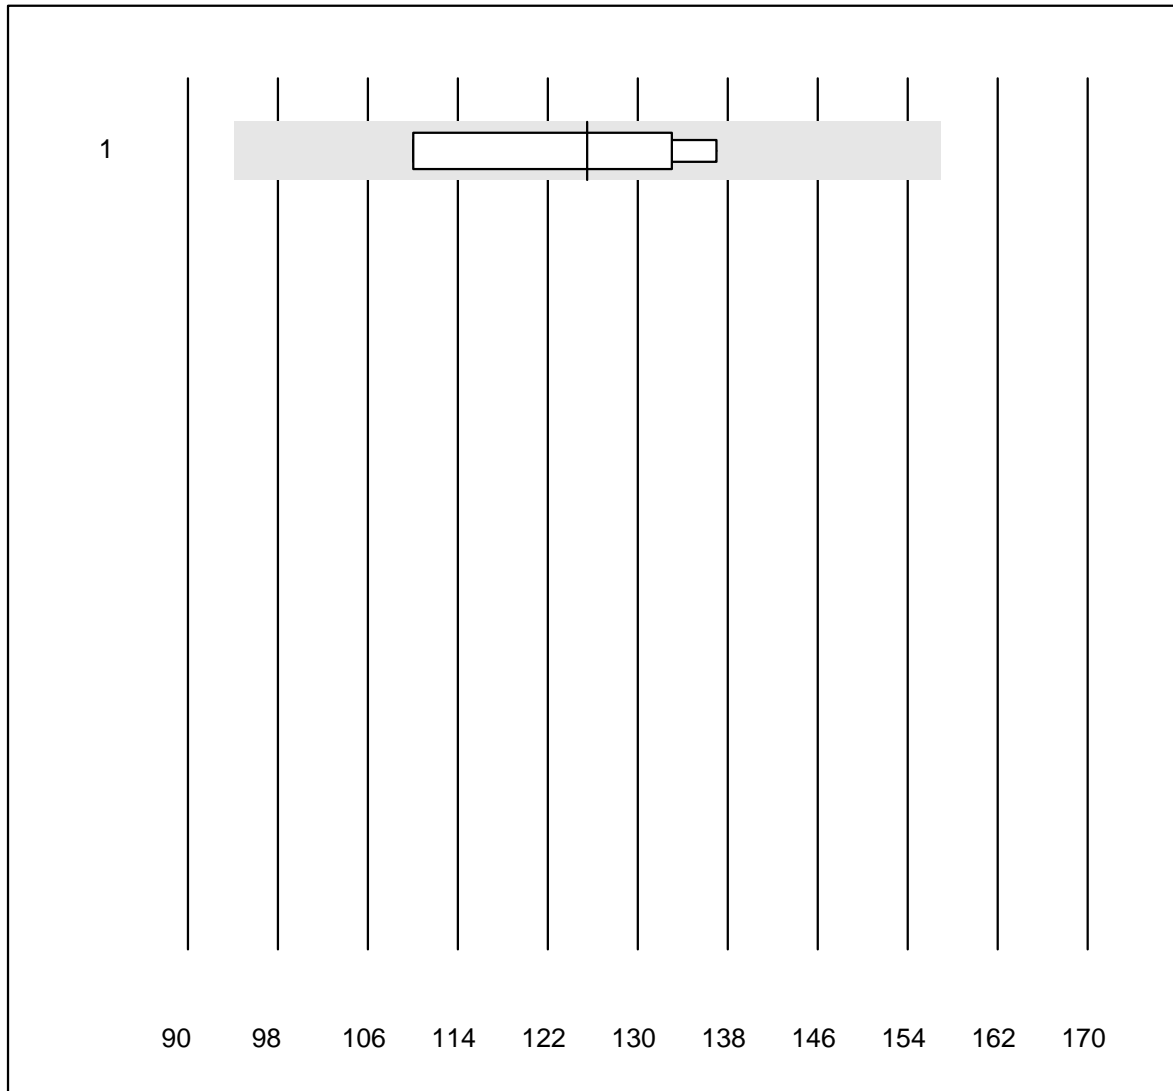


Tolérance MQ : 25 %

EPO (U/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Immulite	4	100.0	0.0	0.0	125.5	10.2	e*

## Parathormone

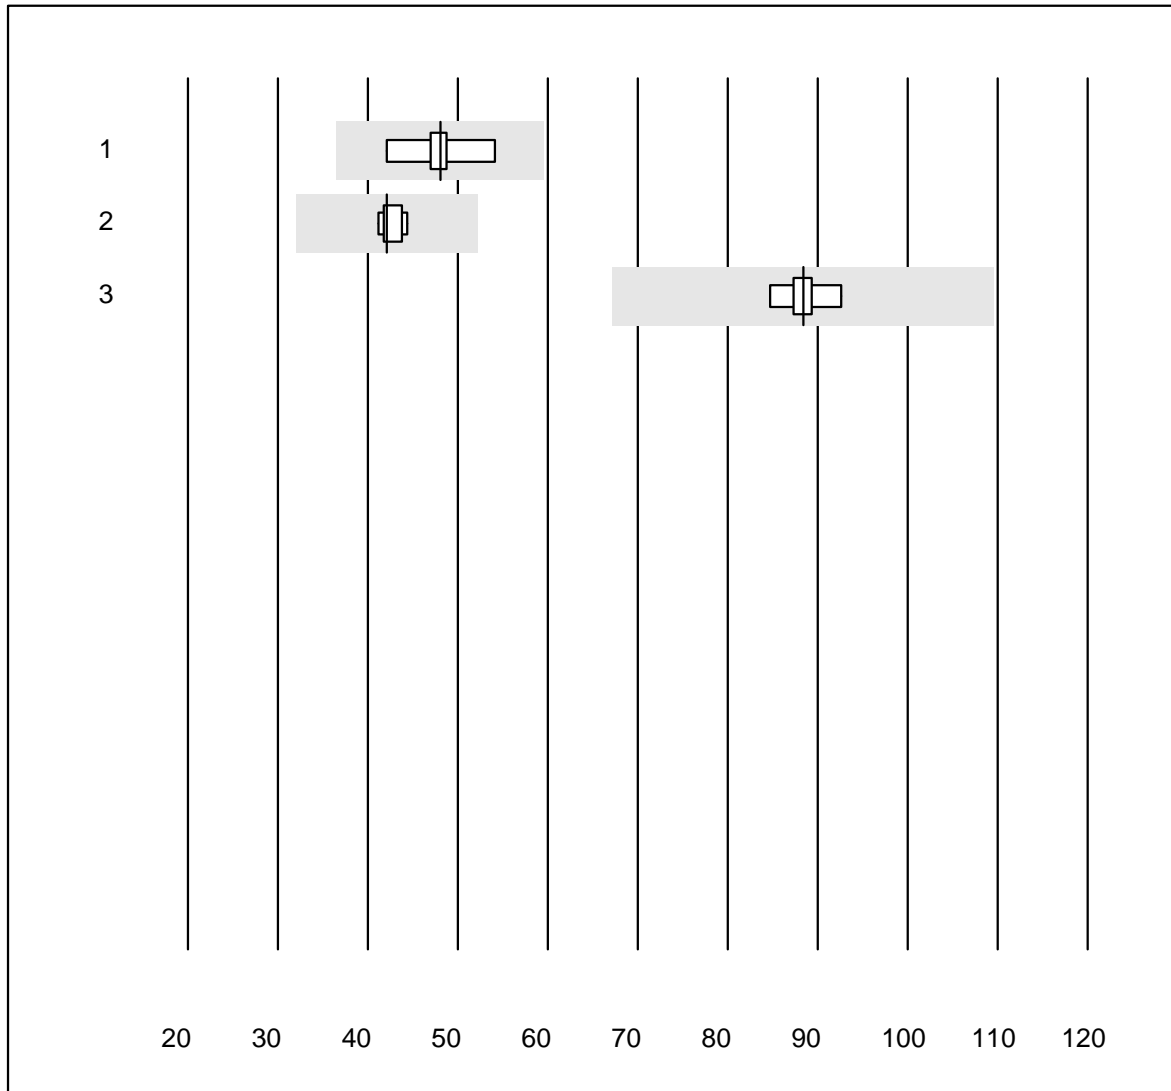


QUALAB Tolérance : 24 %

Parathormone (pmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas PTH STAT	8	100.0	0.0	0.0	48.0	6.8	e
2 Cobas	7	100.0	0.0	0.0	42.1	2.8	e
3 Architect	5	100.0	0.0	0.0	88.4	3.3	e




# Osmolalité

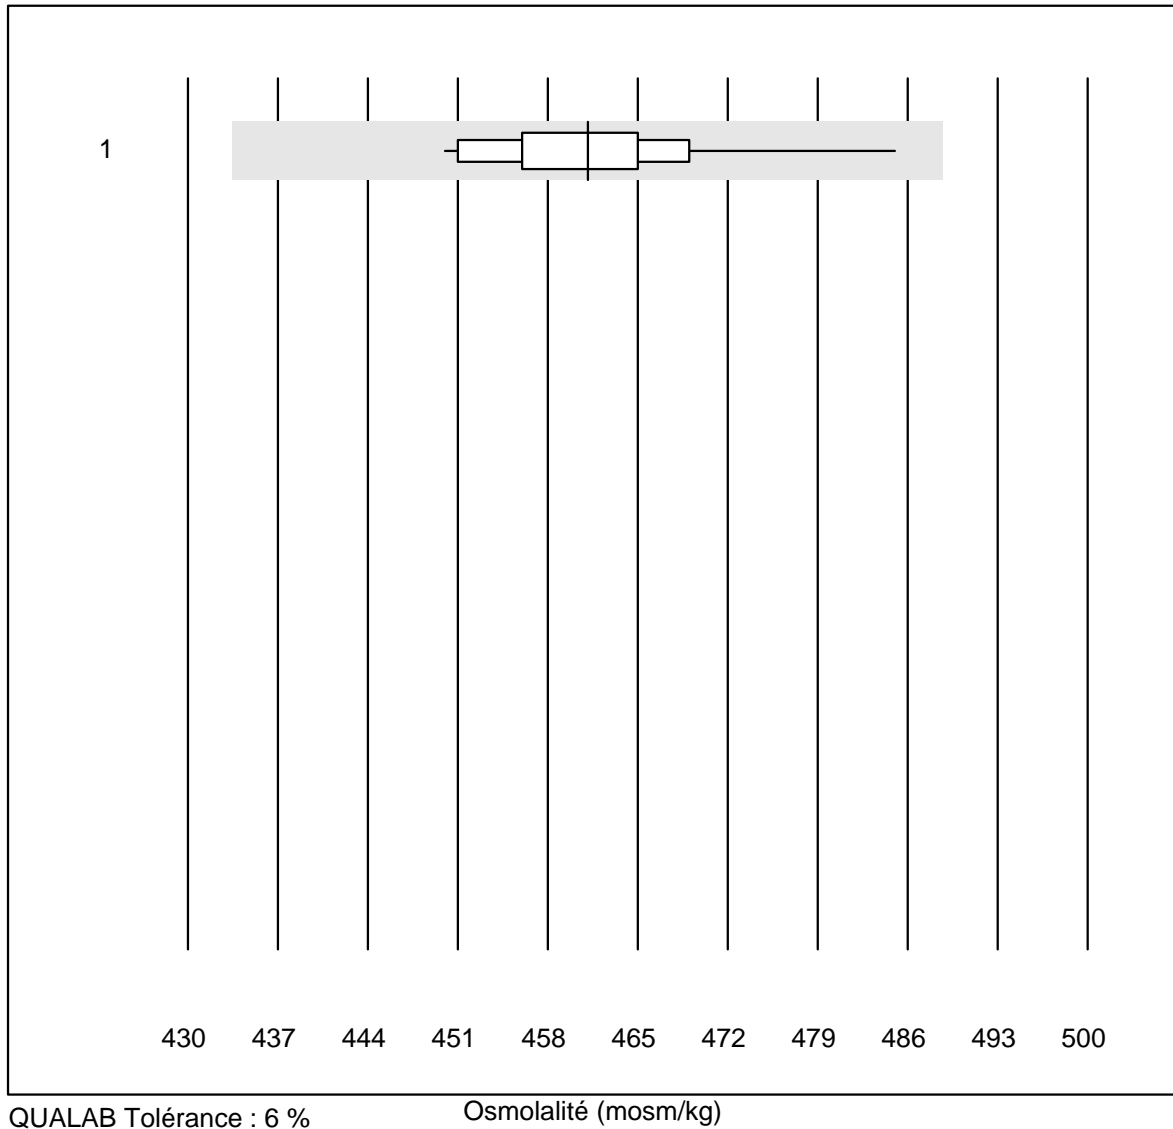

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cryoscopie	17	100.0	0.0	0.0	461	1.8	e

## Kalium-K22

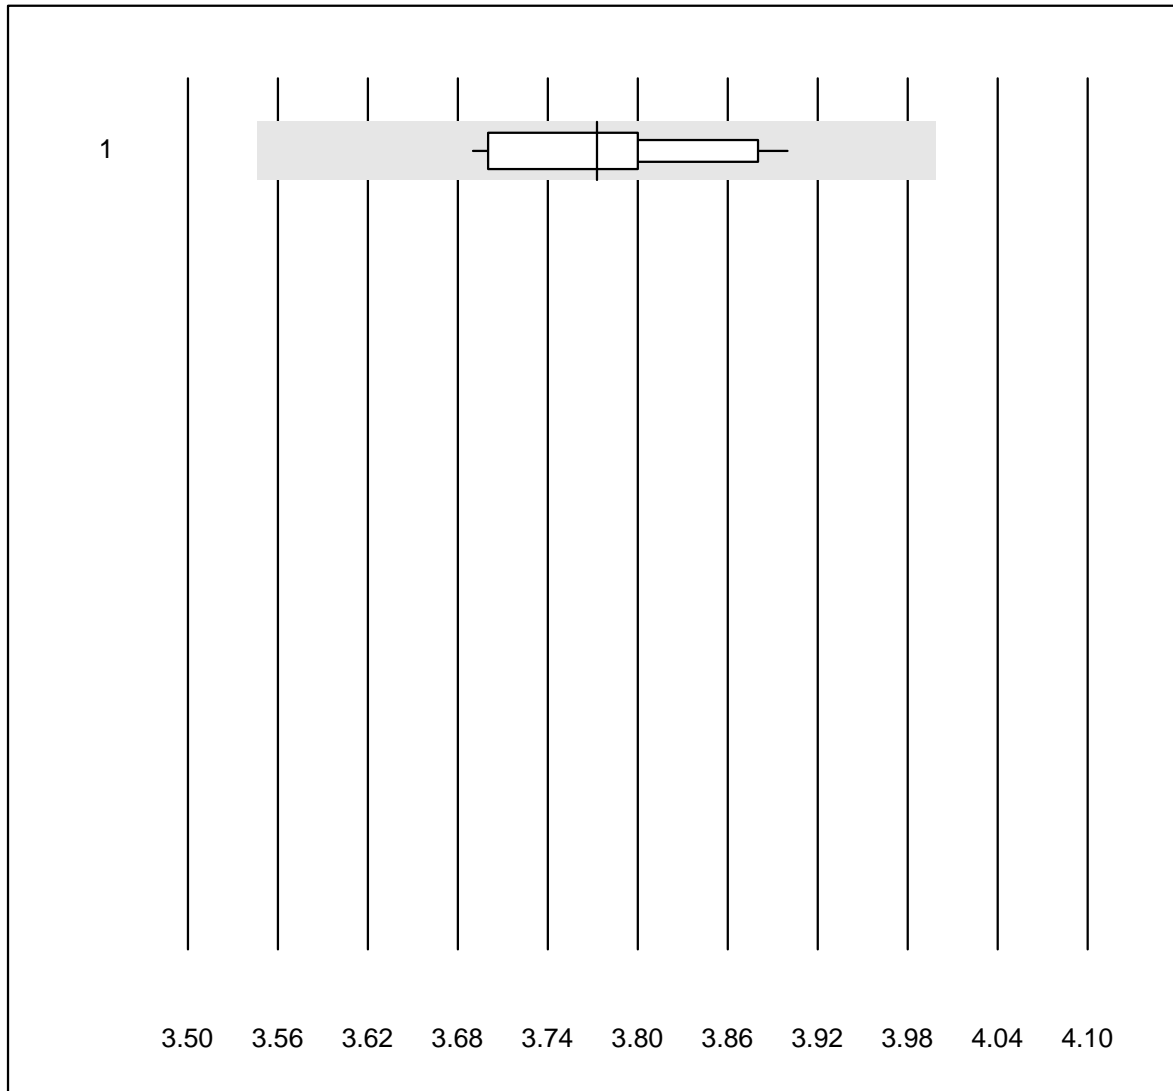


QUALAB Tolérance : 6 %

Kalium-K22 (mmol/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 ISE	11	100.0	0.0	0.0	3.8	1.9	e

## Natrium-K22

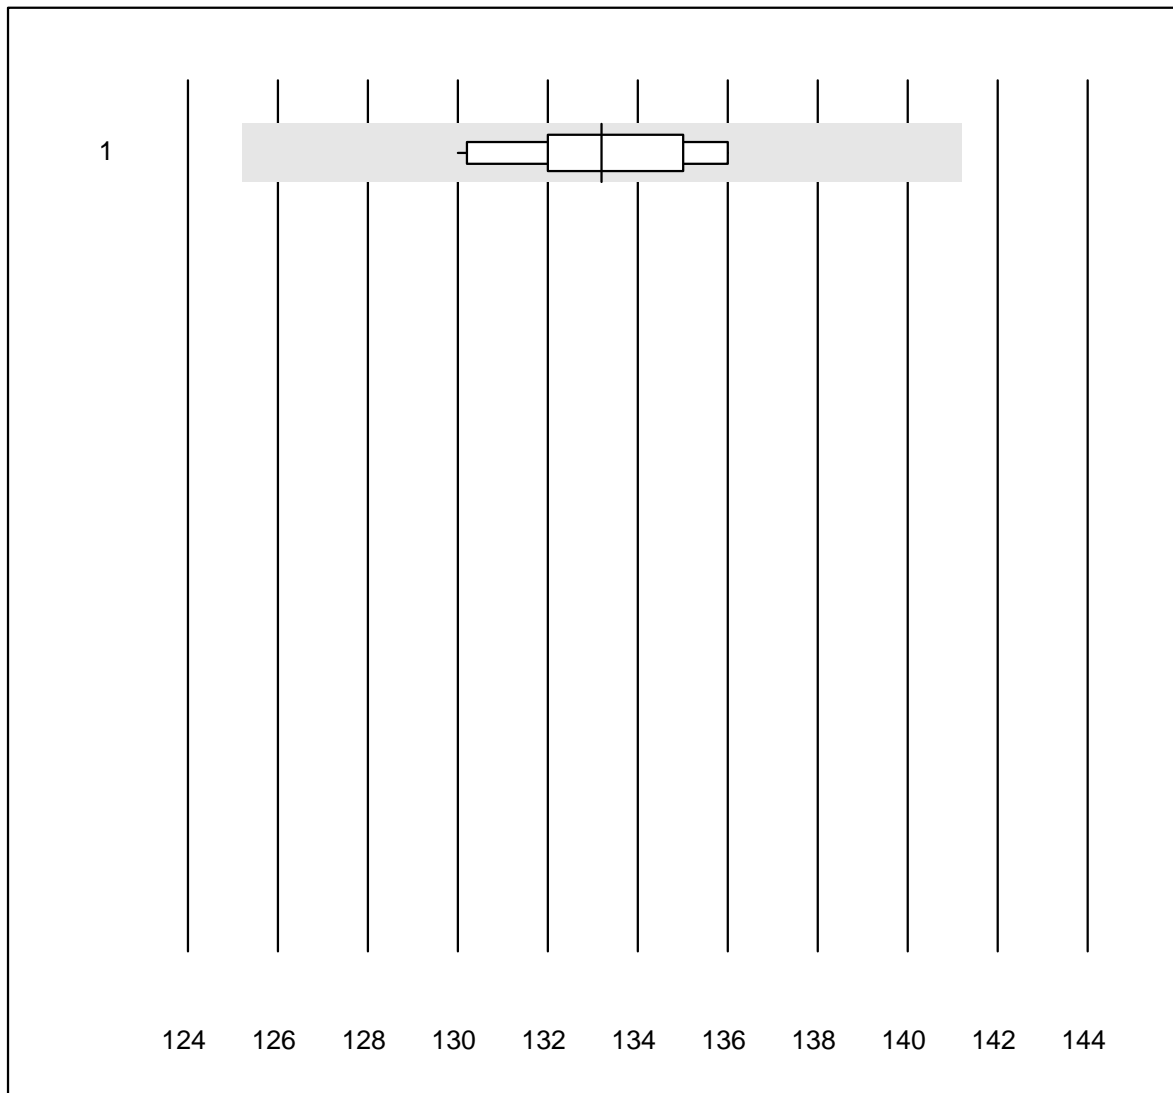


QUALAB Tolérance : 6 %

Natrium-K22 (mmol/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 ISE	11	100.0	0.0	0.0	133	1.6	e

## Glukose-K22

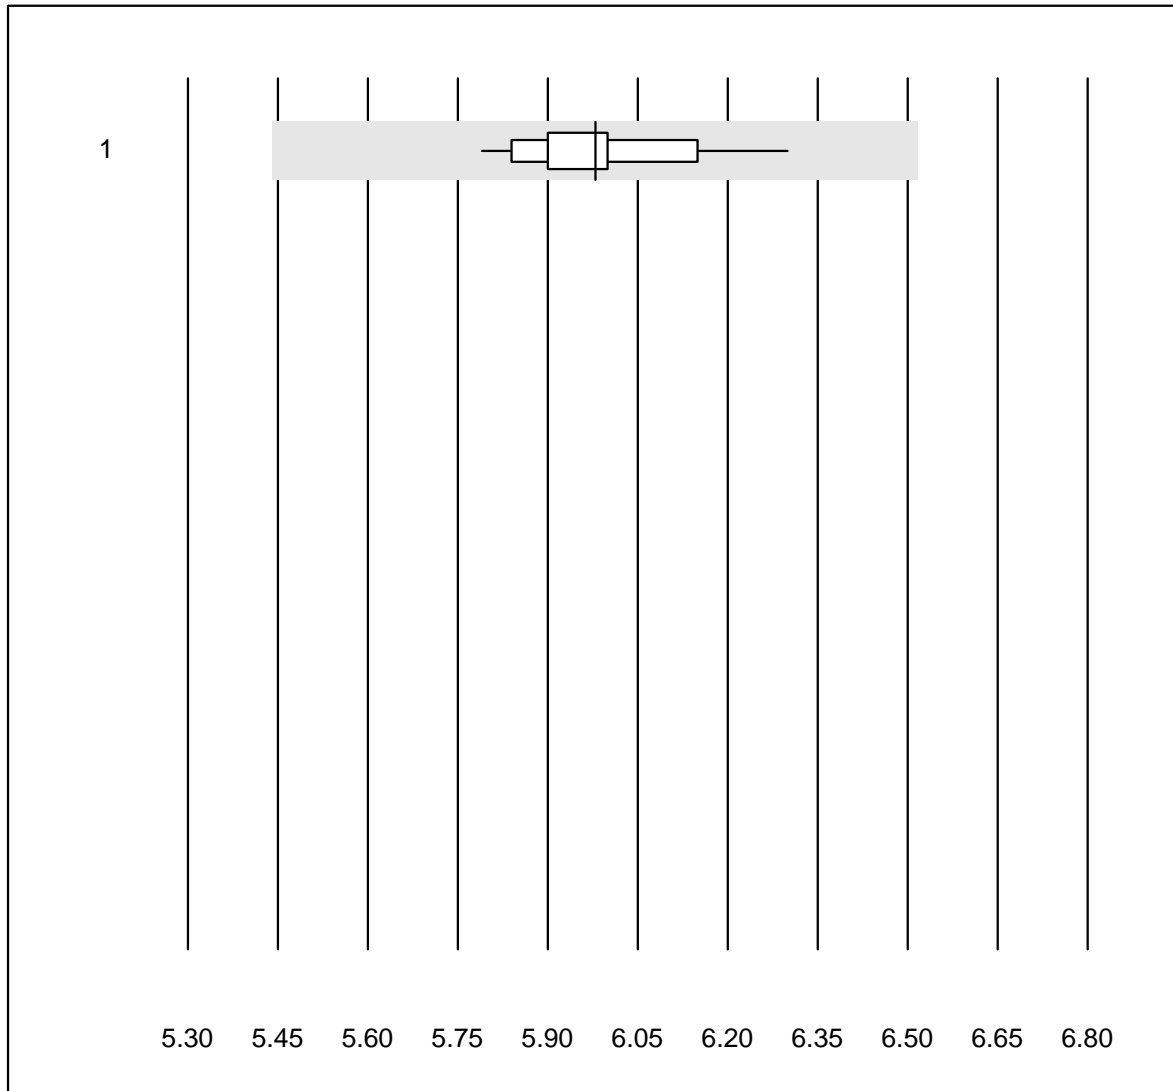


QUALAB Tolérance : 9 %

Glukose-K22 (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	11	100.0	0.0	0.0	6.0	2.4	e

# Harnstoff-K22

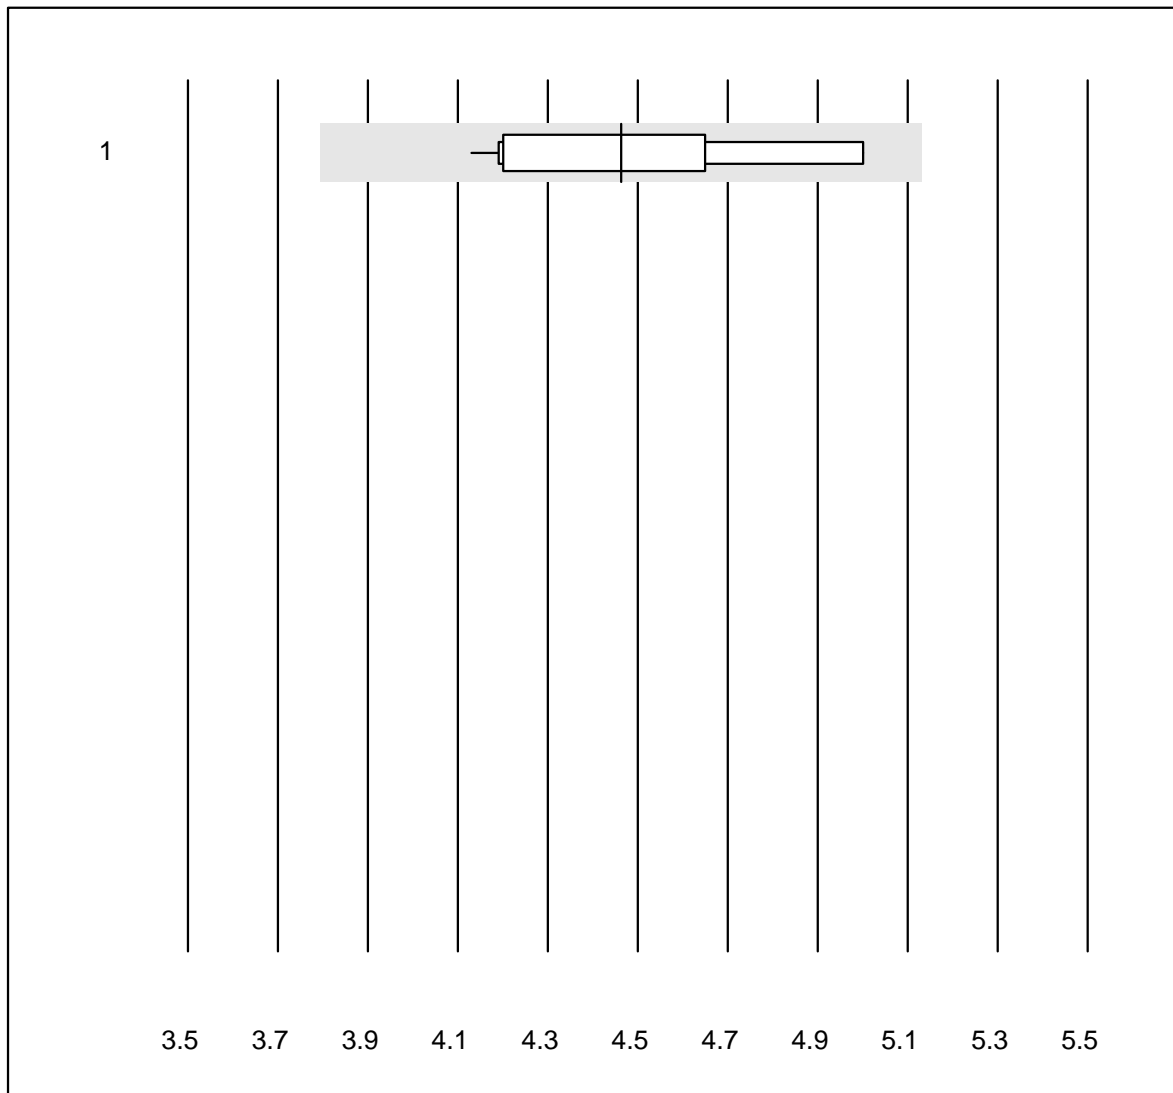


QUALAB Tolérance : 15 %

Harnstoff-K22 (mmol/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	11	100.0	0.0	0.0	4.5	6.8	e*

## Osmotische Lücke

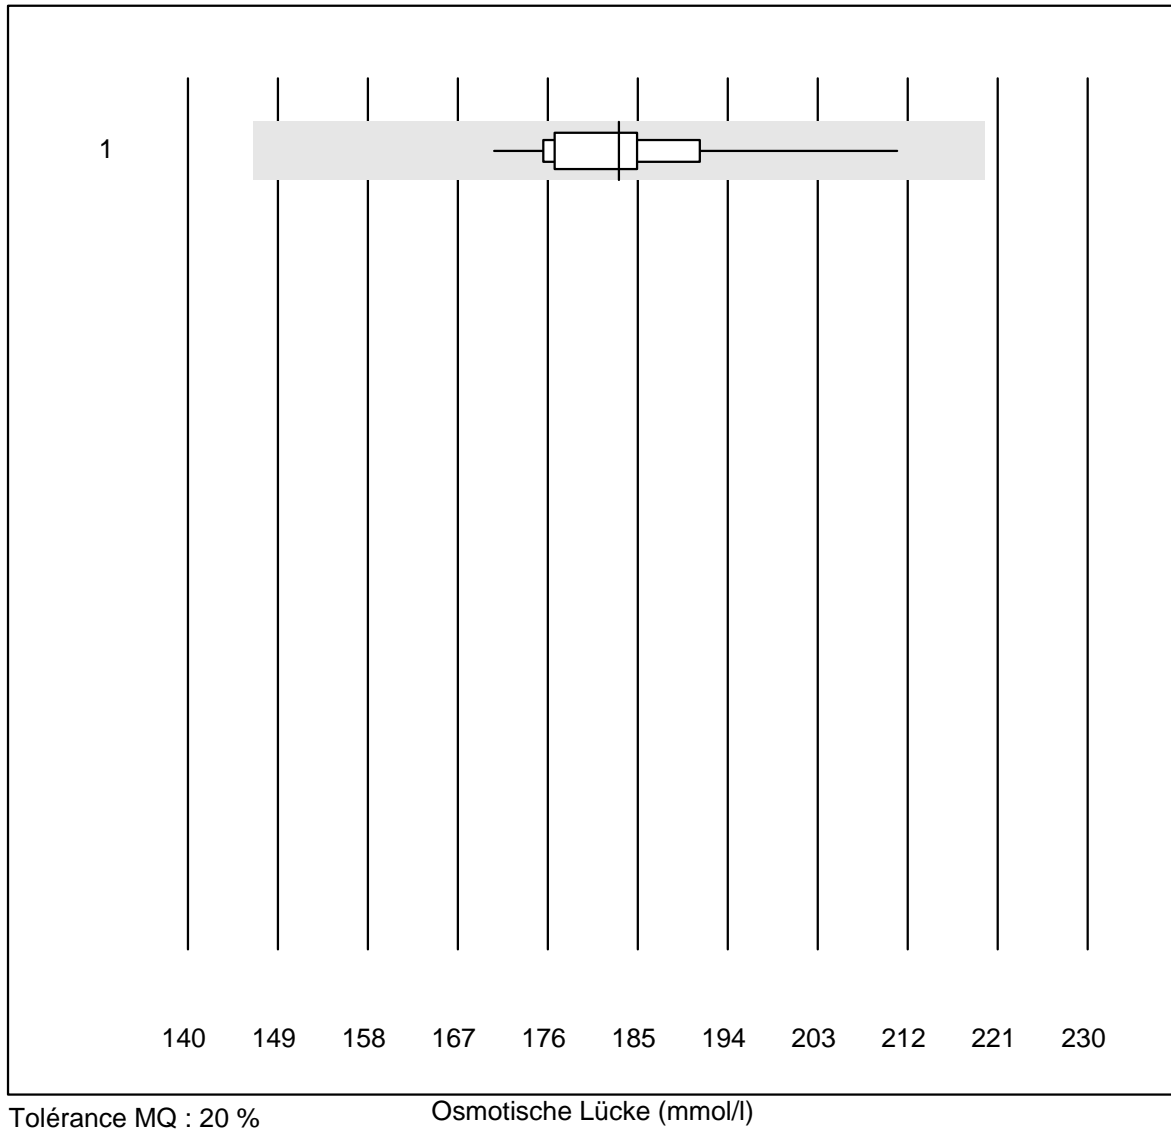

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Formel 1 (2Na+K+Glu+	11	100.0	0.0	0.0	183.1	5.9	e

# Digoxin

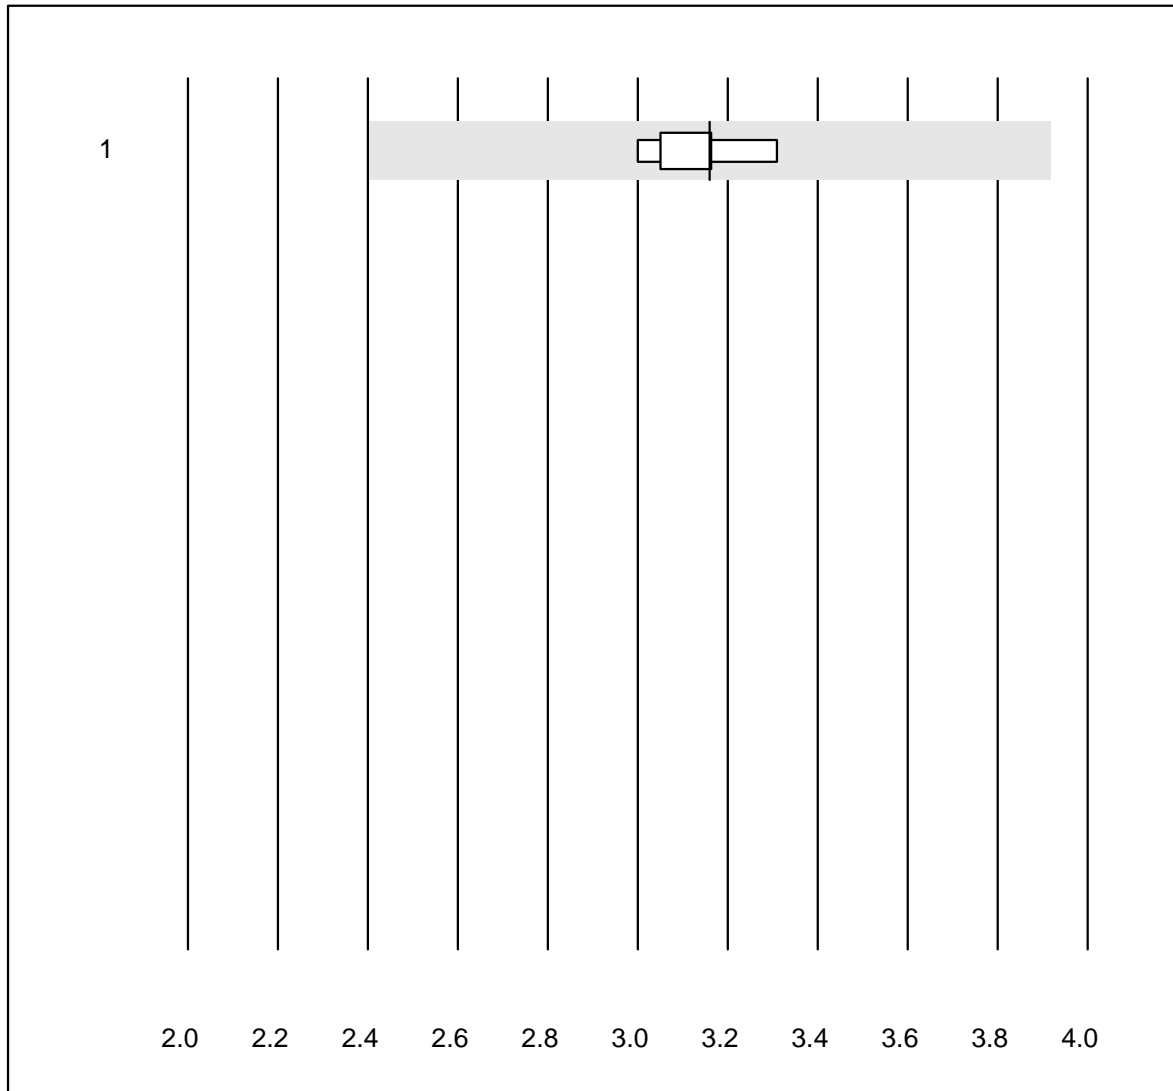


QUALAB Tolérance : 24 %

Digoxin (nmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Autres méthodes	6	100.0	0.0	0.0	3.16	3.5	e

# Valproat

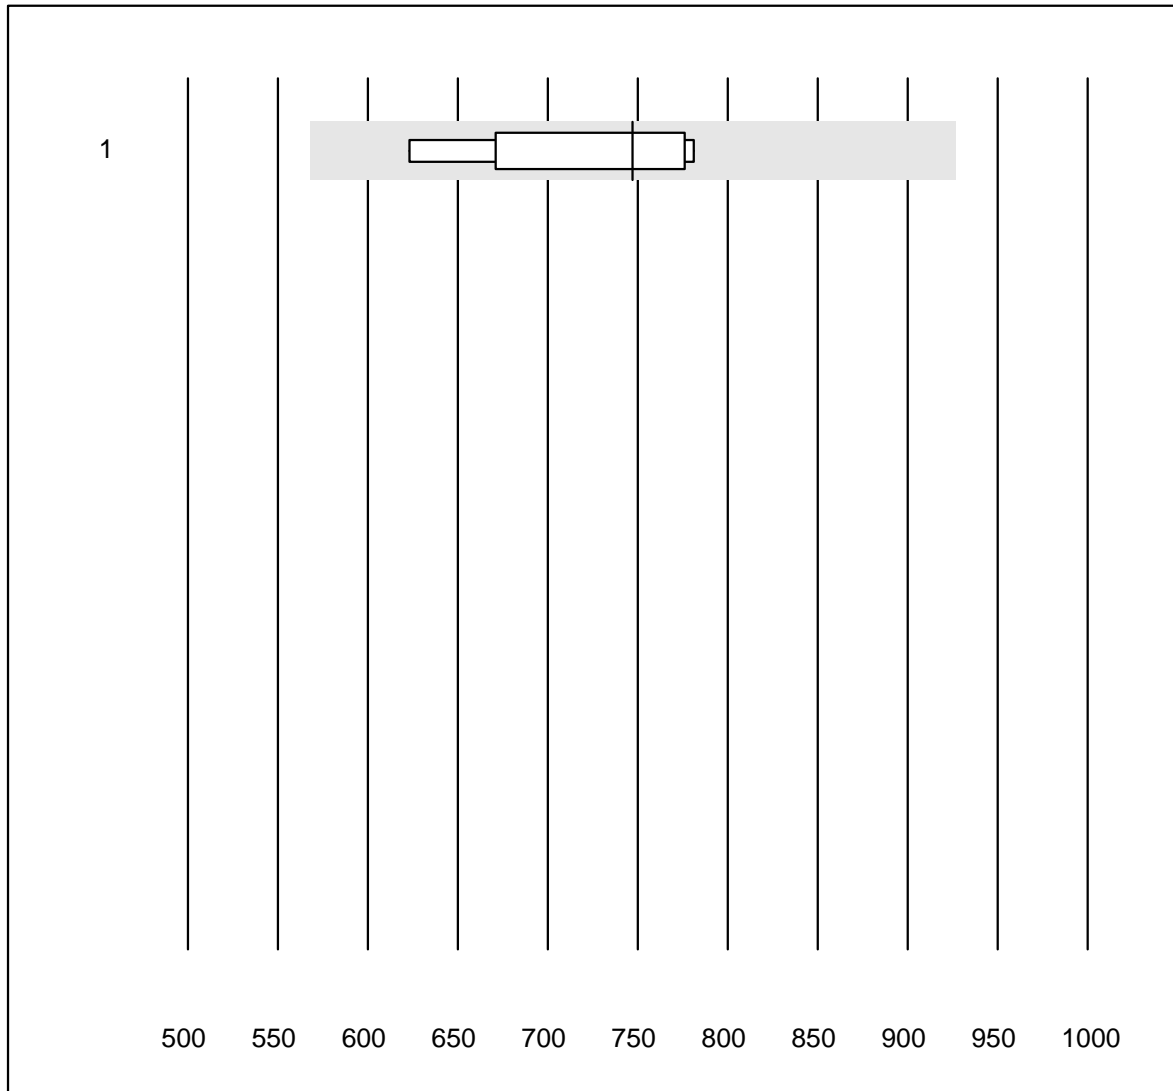


Tolérance MQ : 24 %

Valproat (µmol/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	747.0	8.7	e*



## Cystatin C

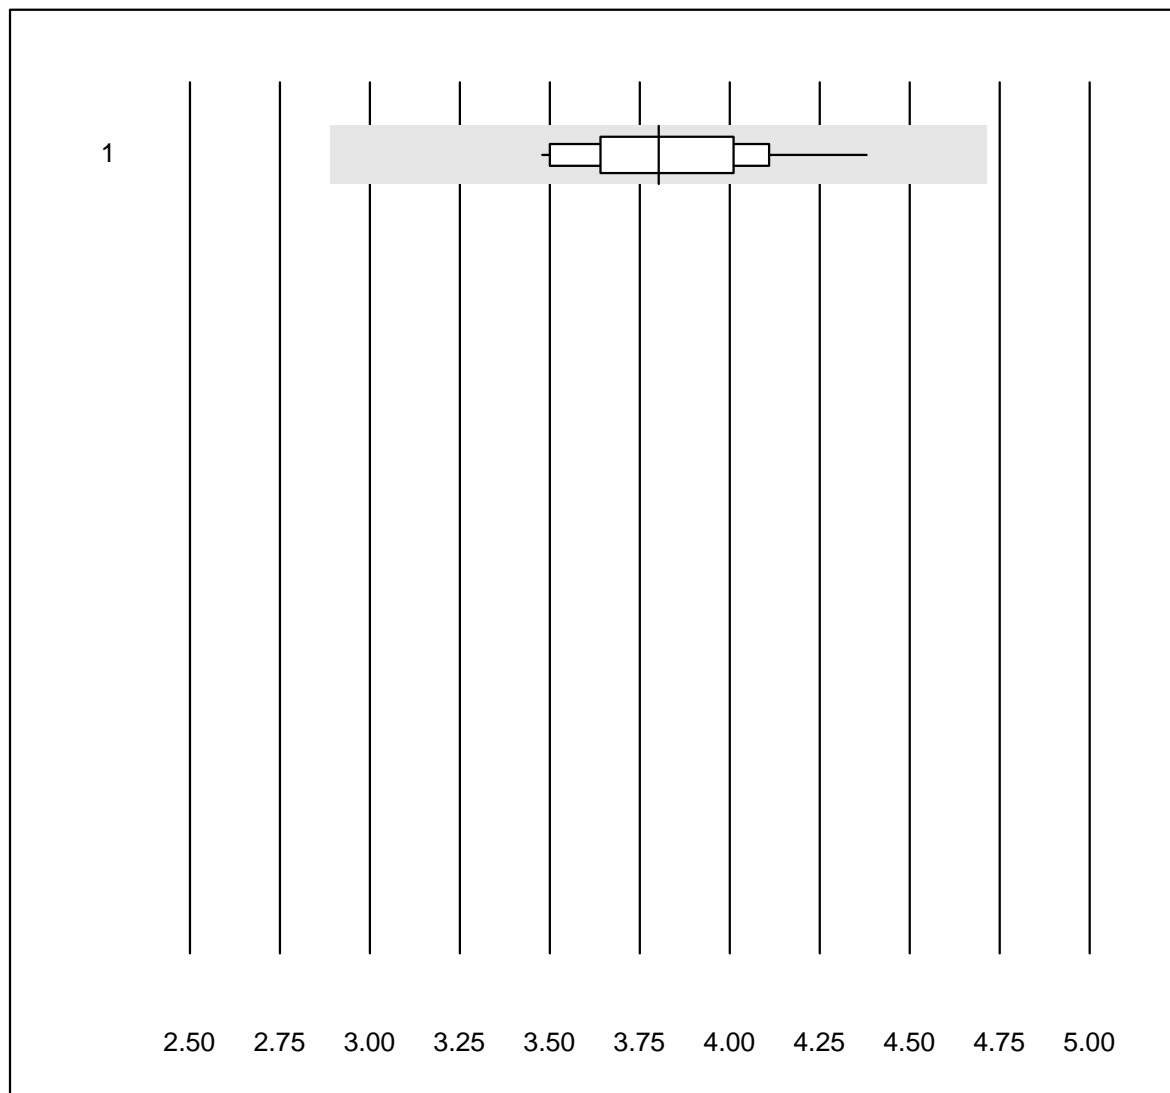


Tolérance MQ : 24 %

Cystatin C (mg/l)


No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	12	91.7	0.0	8.3	3.80	7.1	e

# Éthanol

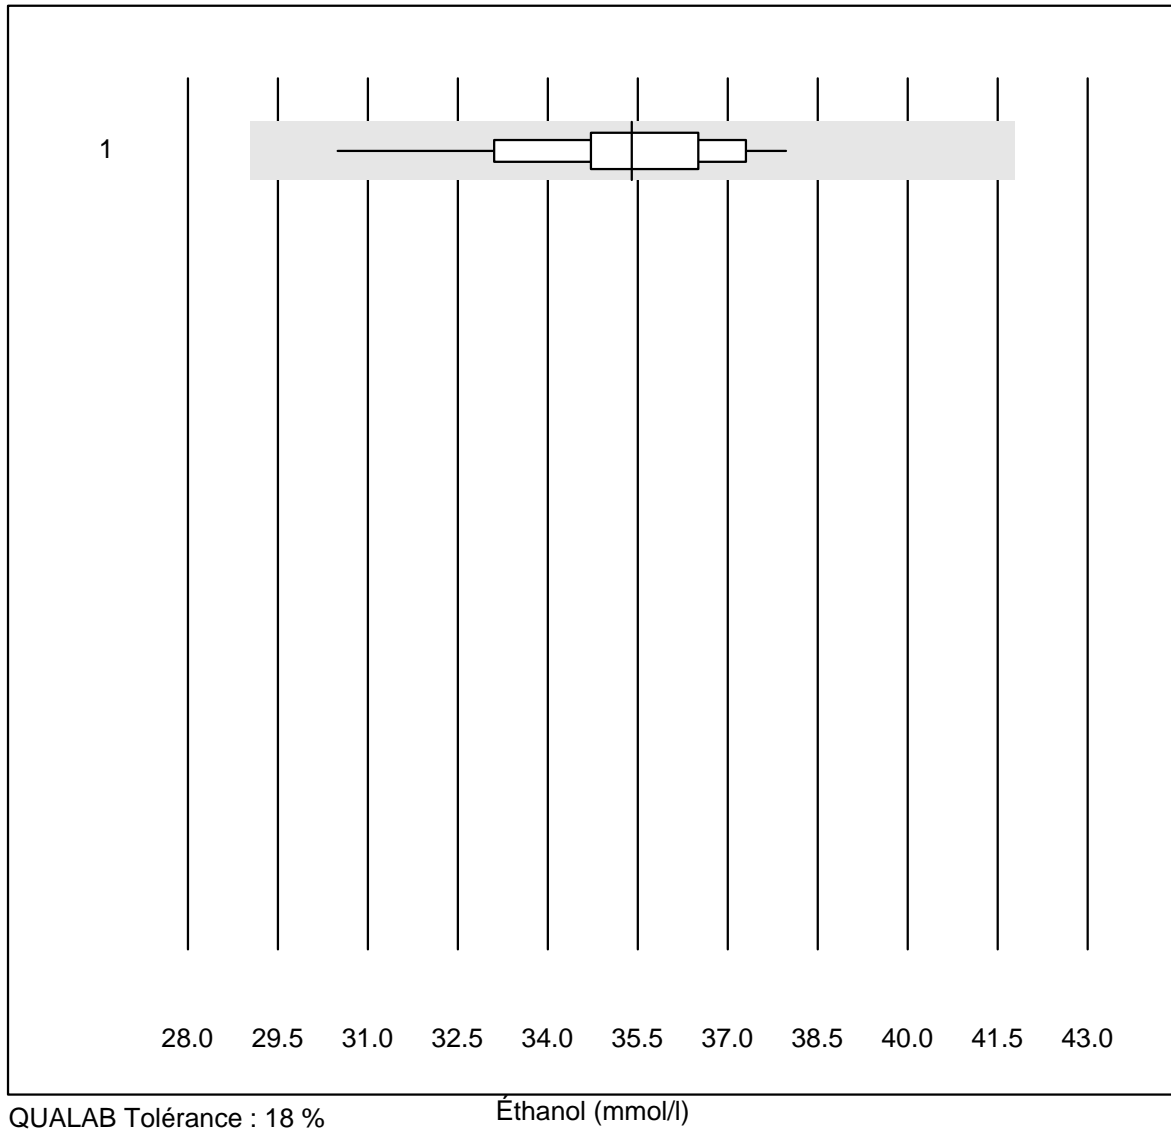


No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	26	100.0	0.0	0.0	35.4	4.9	e

## Ammoniac

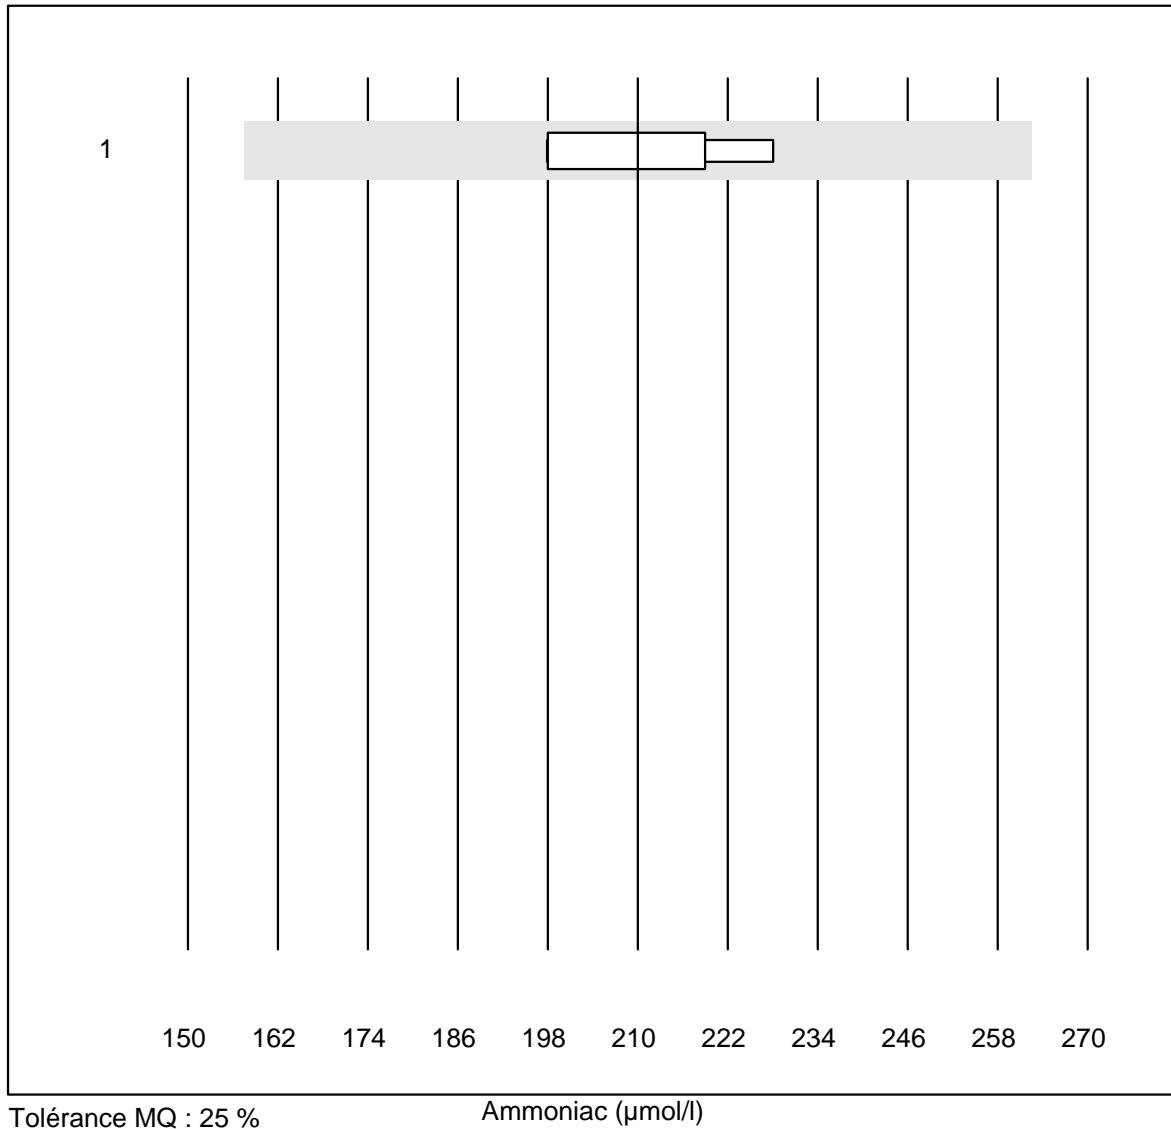


No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	210.0	6.3	e

# Calprotectine

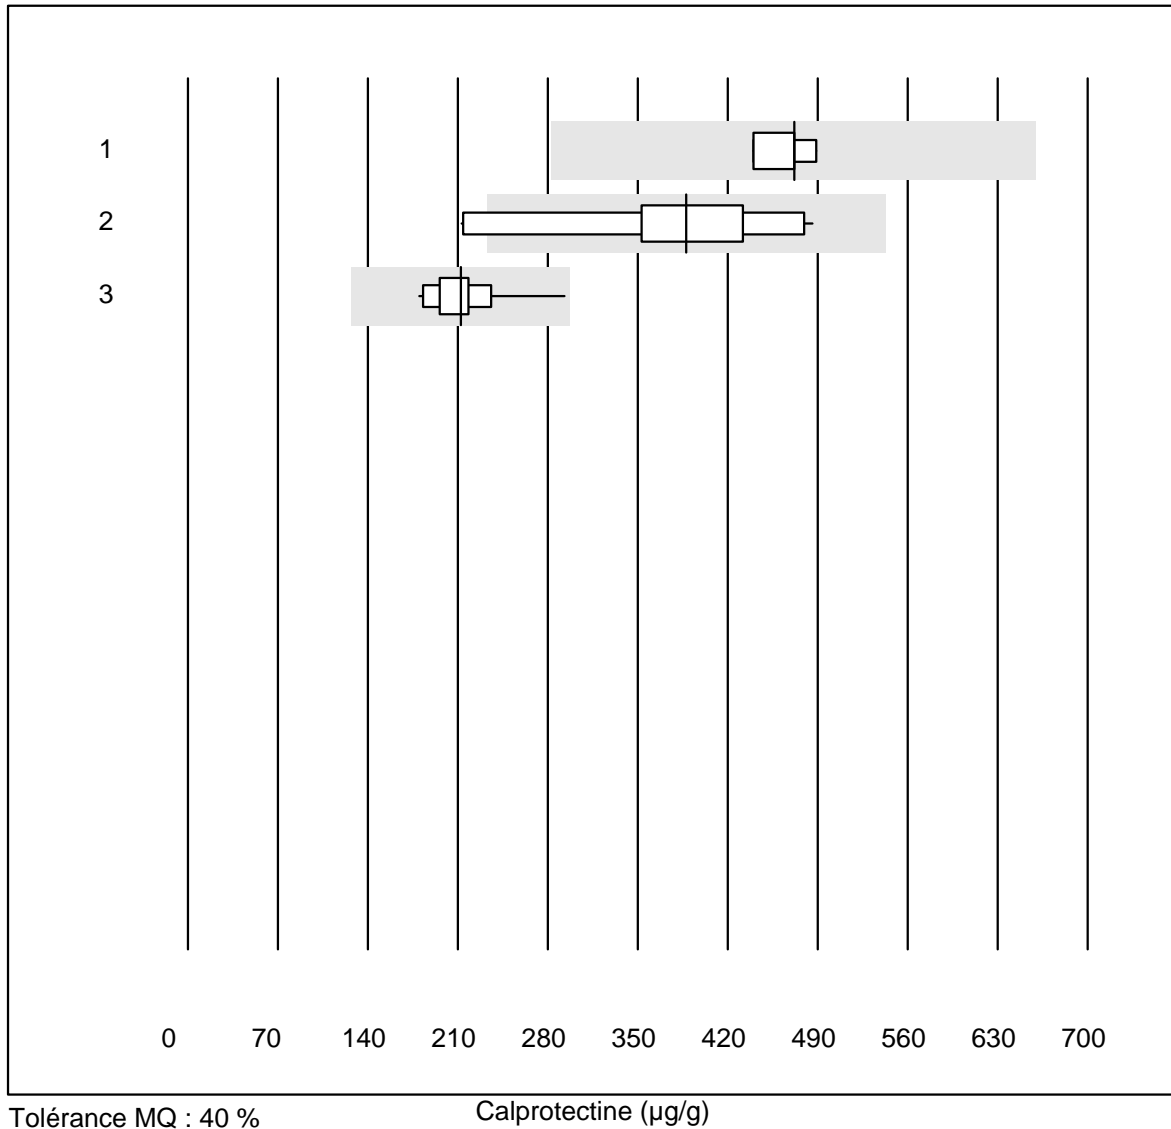

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Bühlmann ELISA	5	80.0	0.0	20.0	472	4.3	e
2 Bühlmann fCALturbo	13	76.9	15.4	7.7	388	23.3	e*
3 Liaison	20	100.0	0.0	0.0	212	12.1	e

## Cholestérol Af/b101

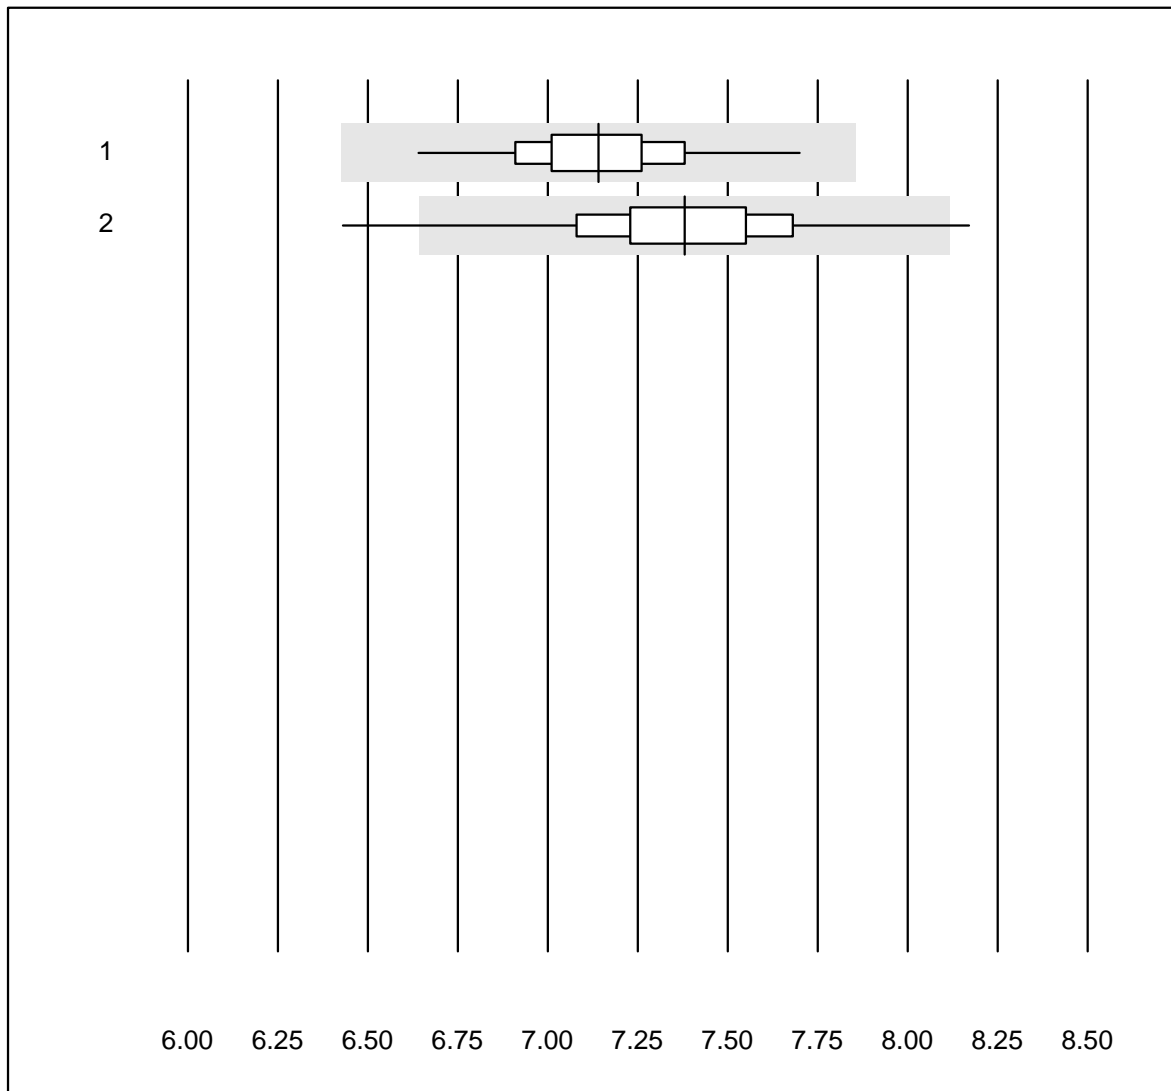


QUALAB Tolérance : 10 %

Cholestérol Af/b101 (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas b101	220	99.5	0.0	0.5	7.14	2.5	e
2 Afinion	434	97.7	0.7	1.6	7.38	3.4	e

## Cholestérol HDL Af/b101

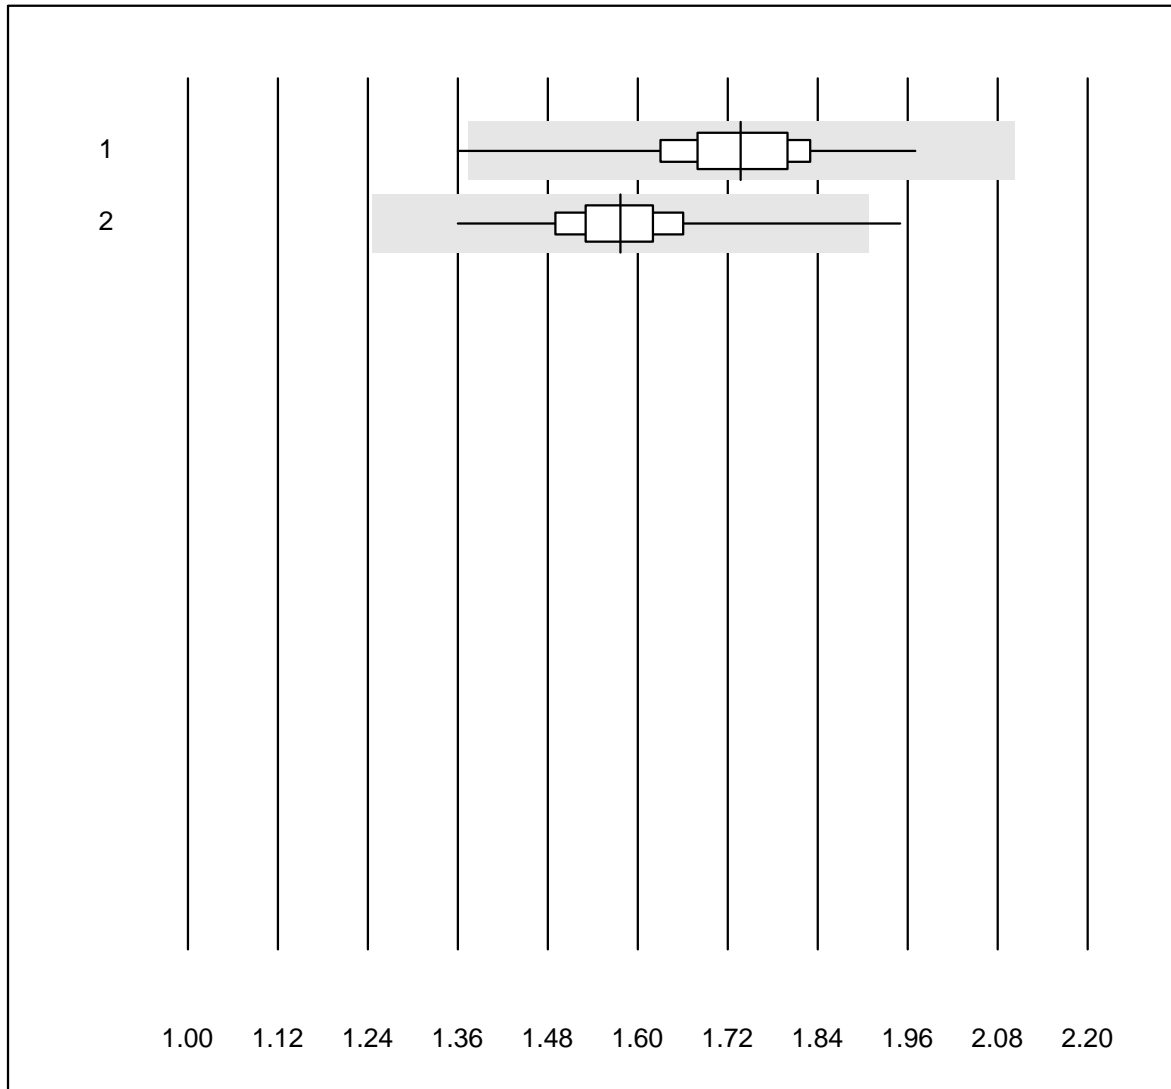


QUALAB Tolérance : 21 %

Cholestérol HDL Af/b101 (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas b101	219	91.3	0.5	8.2	1.74	4.8	e
2 Afinion	429	92.6	0.2	7.2	1.58	4.8	e

## Triglycerides Af/b101

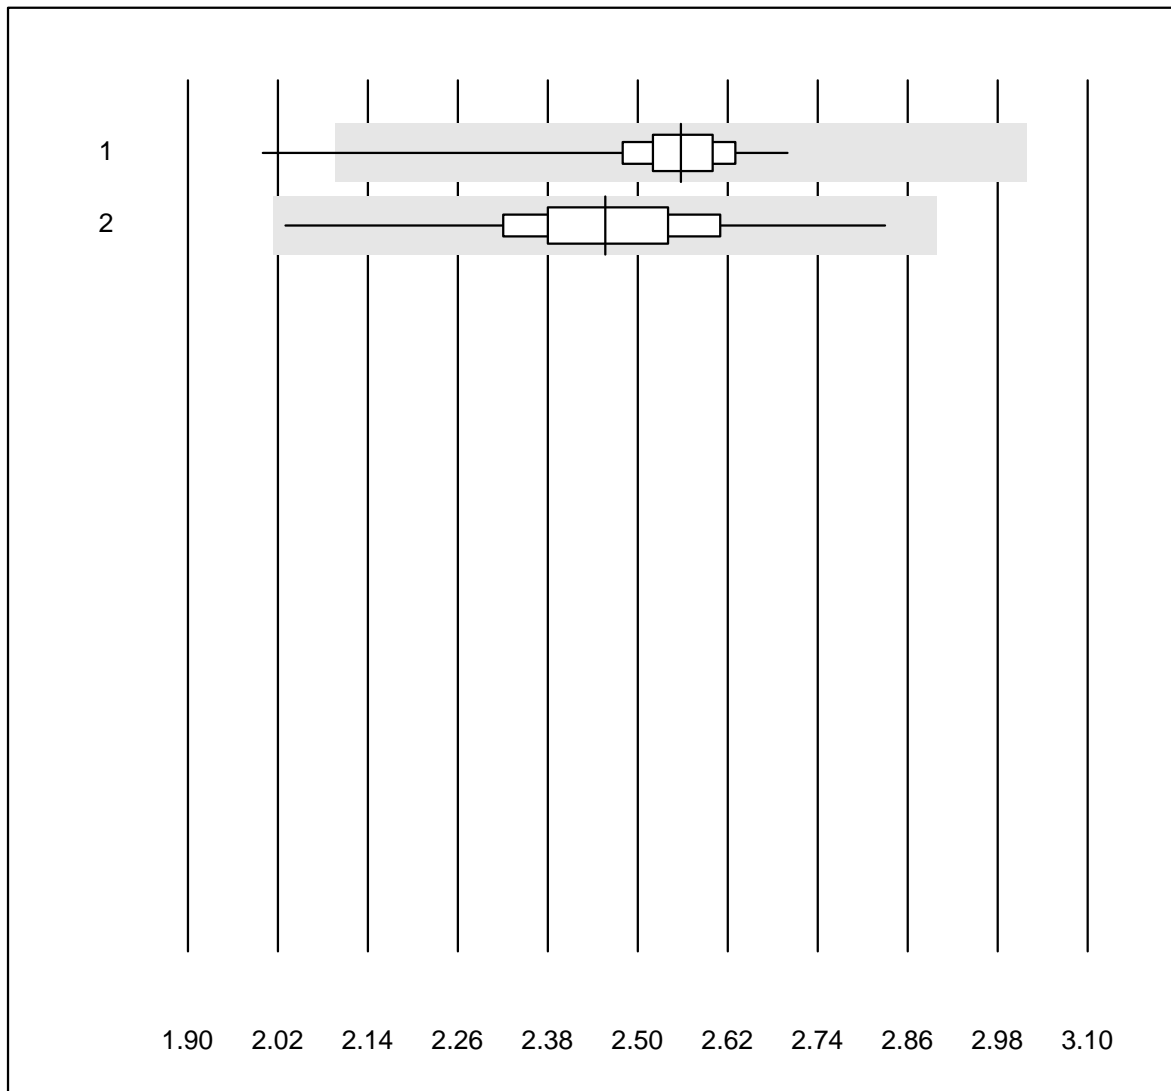


QUALAB Tolérance : 18 %

Triglycerides Af/b101 (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas b101	218	99.0	0.5	0.5	2.56	2.6	e
2 Afinion	435	99.3	0.0	0.7	2.46	4.8	e

## Troponine I S

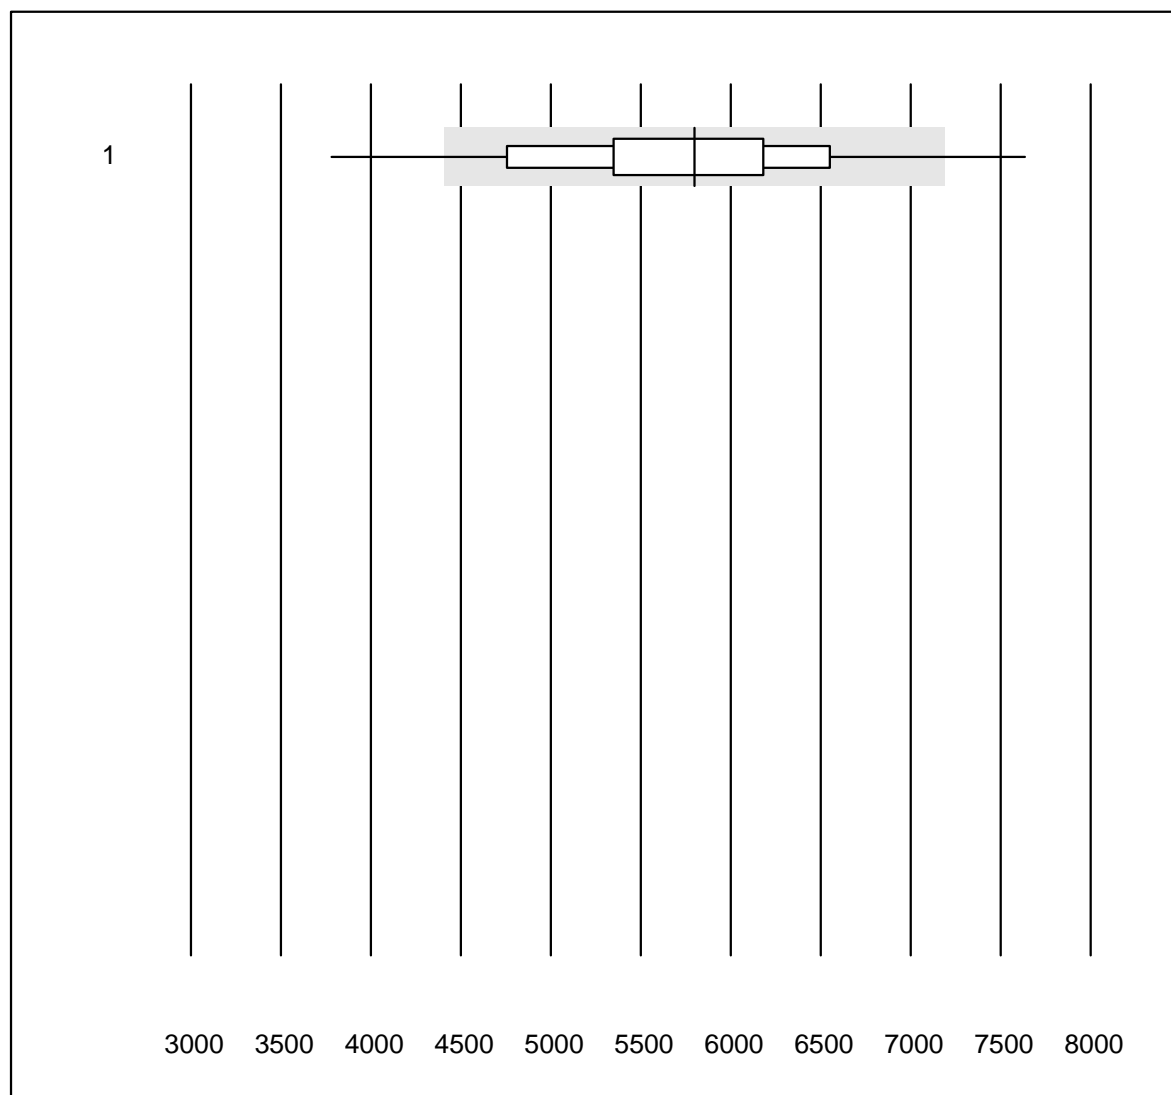


QUALAB Tolérance : 24 %

Troponine I S (ng/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 AFIAS	182	84.1	8.8	7.1	5799.00	12.7	e



## D-Dimères qn S

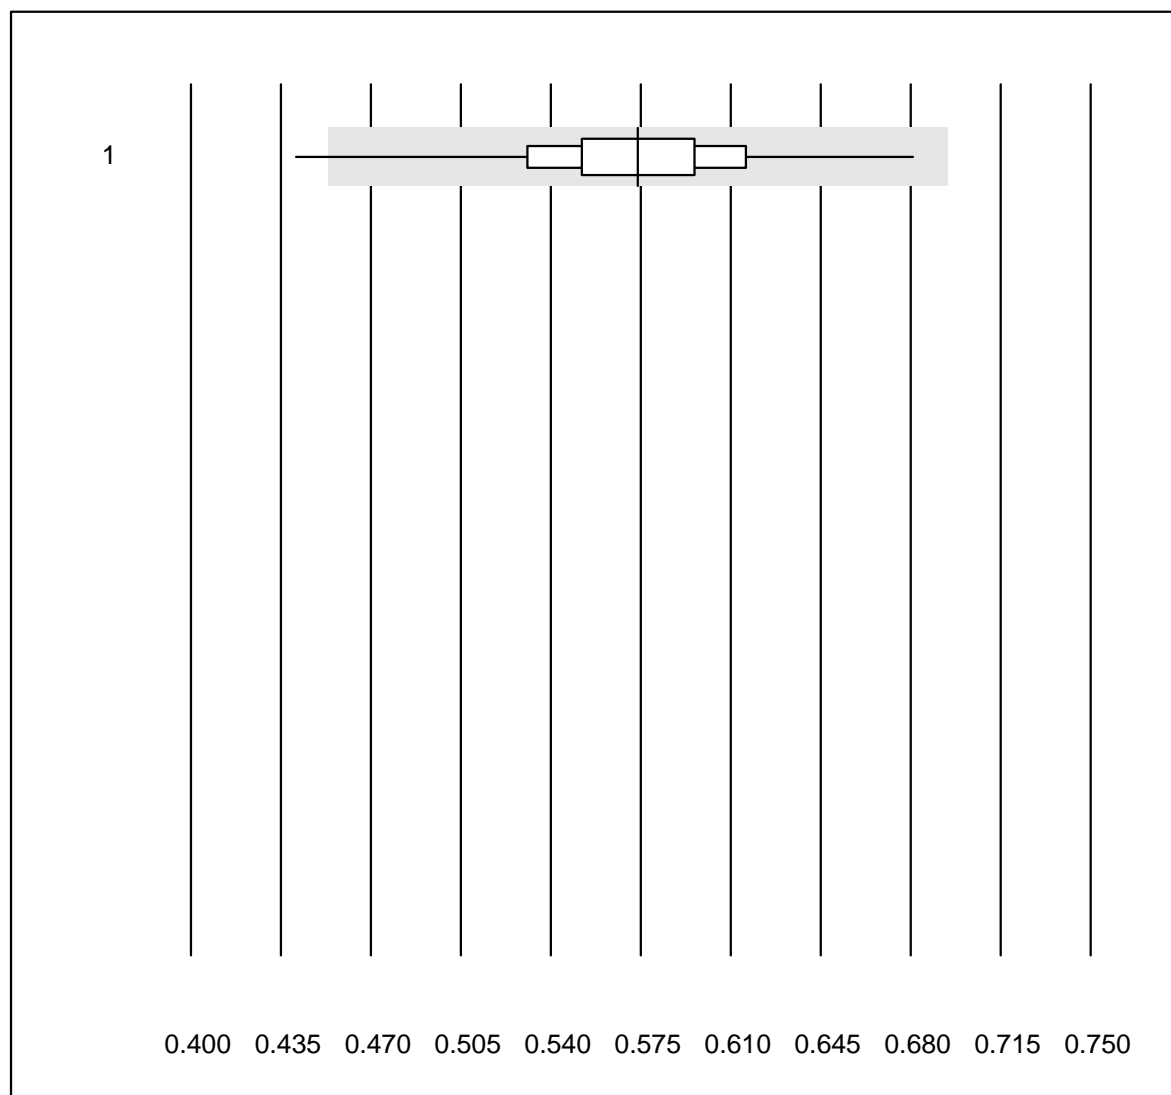


QUALAB Tolérance : 21 %

D-Dimères qn S (mg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 AFIAS	188	86.7	0.5	12.8	0.57	6.6	e

## NT-proBNP S

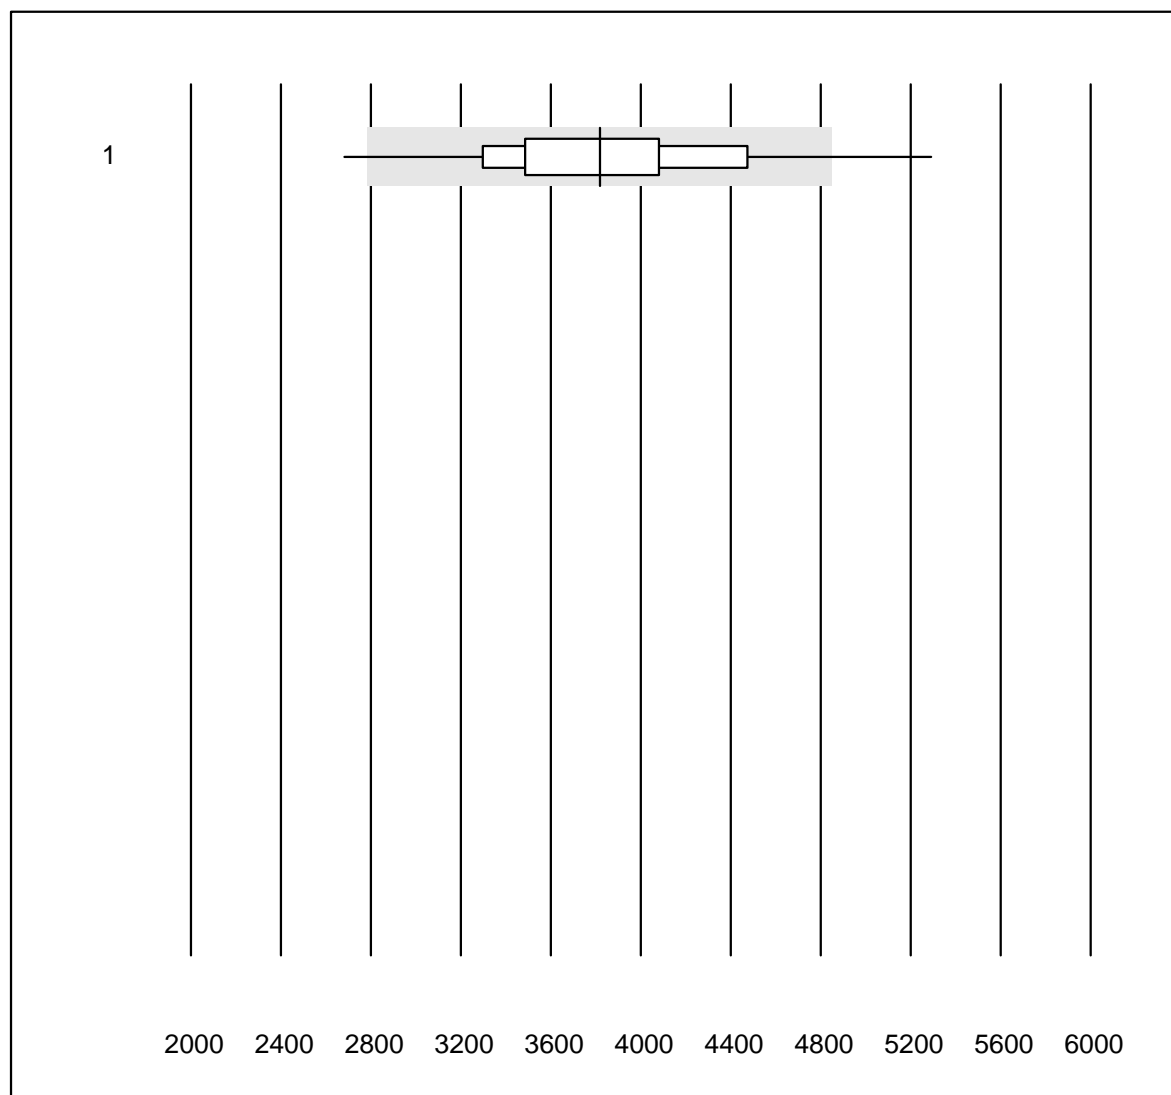


QUALAB Tolérance : 27 %

NT-proBNP S (ng/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 AFIAS	141	91.5	3.5	5.0	3818.5	12.5	e

# Lipase

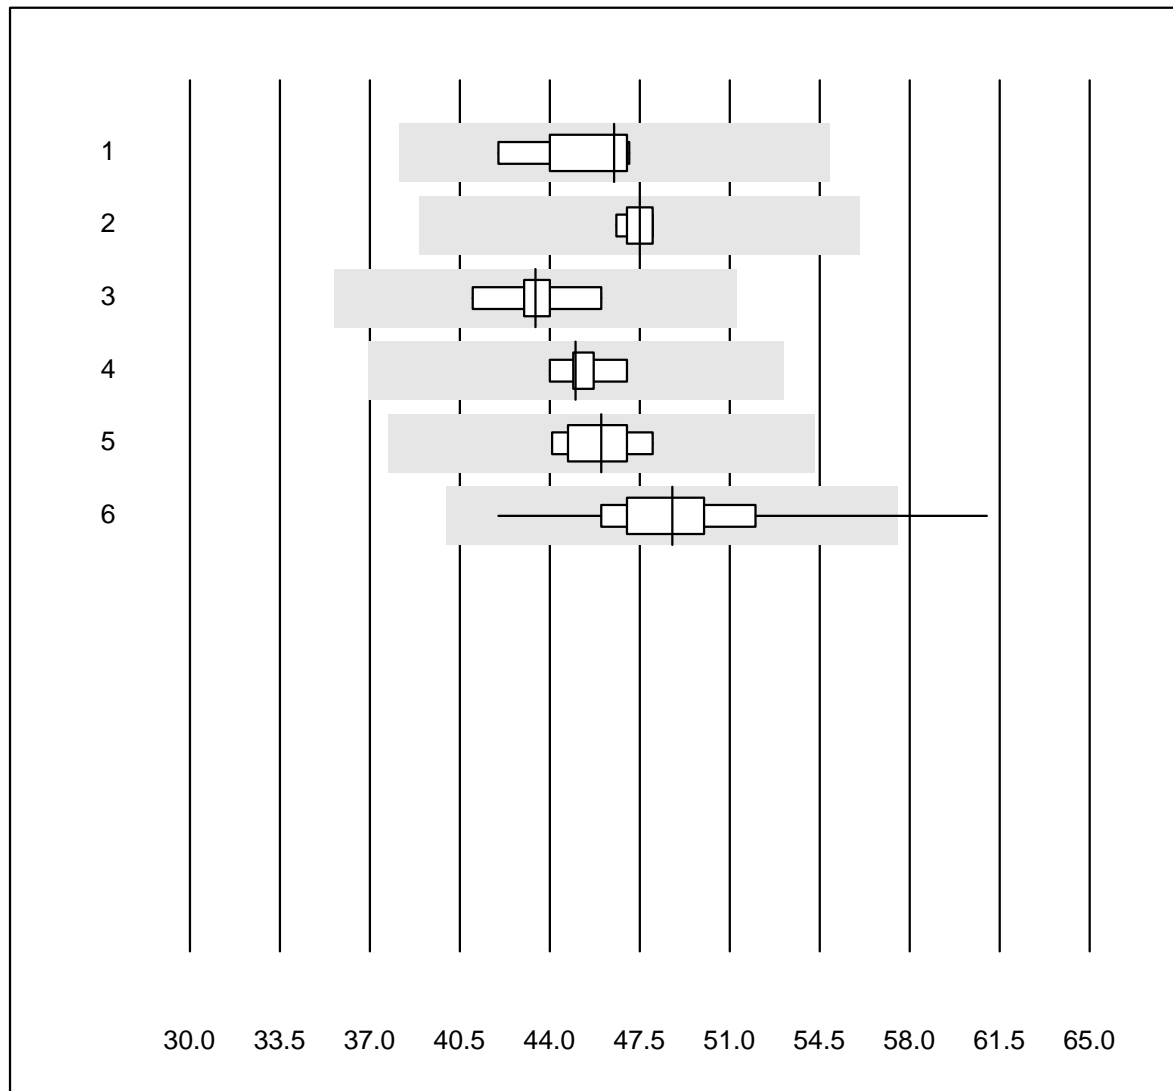


QUALAB Tolérance : 18 %

Lipase (U/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Roche	5	100.0	0.0	0.0	46.5	5.0	e*
2 Alinity	6	100.0	0.0	0.0	47.5	1.3	e
3 Architect	6	100.0	0.0	0.0	43.5	3.8	e
4 Beckman	6	100.0	0.0	0.0	45.0	2.2	e
5 Cobas	6	100.0	0.0	0.0	46.0	3.2	e
6 Fuji Dri-Chem	165	97.6	1.2	1.2	48.8	5.5	e

## Bicarbonat

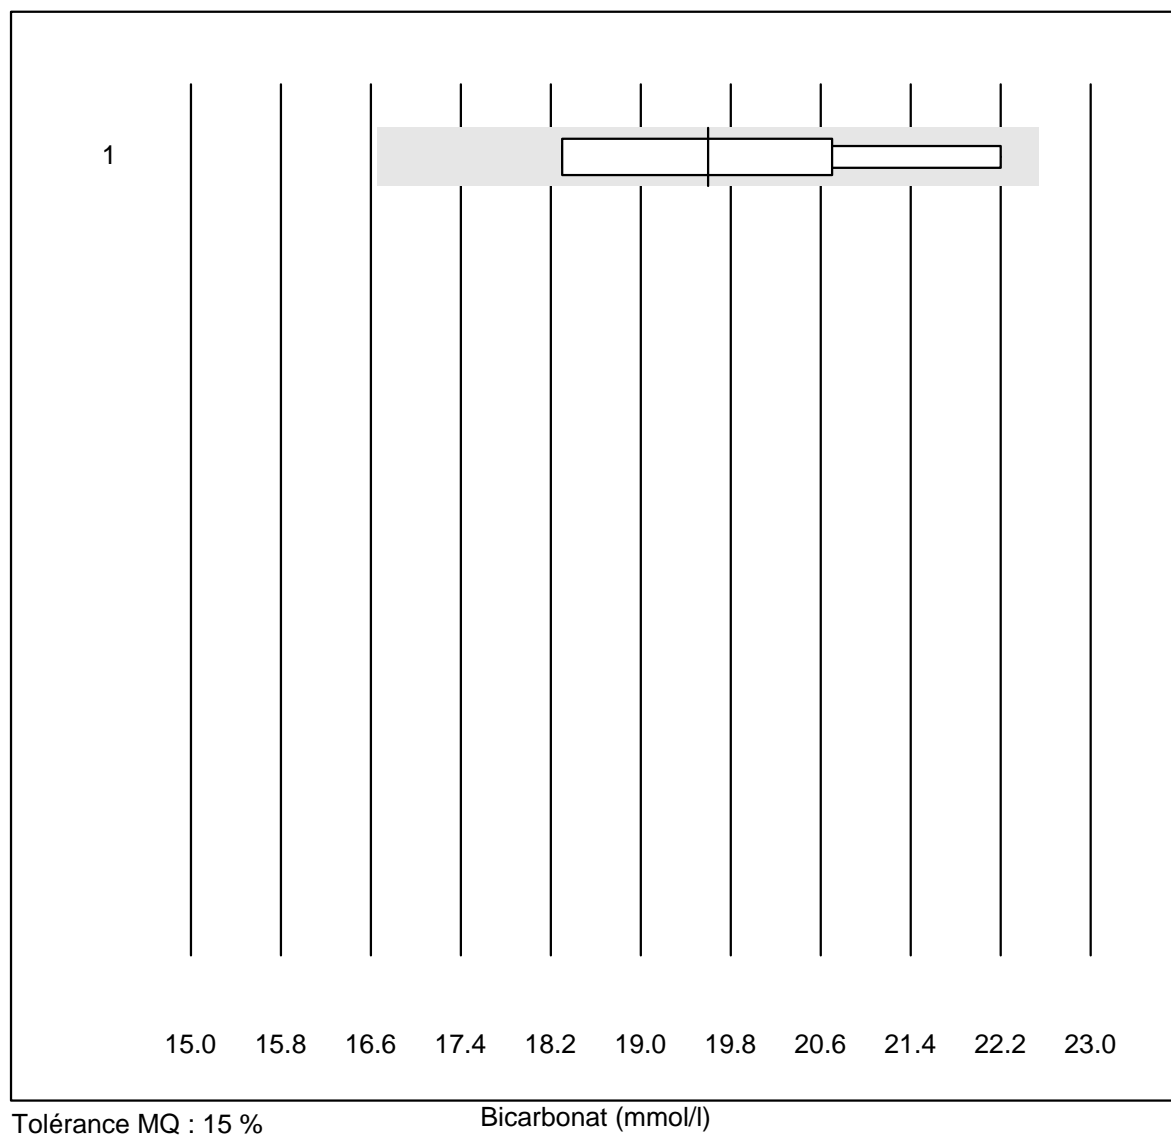

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	19.6	9.4	e*

## Glucose CSF

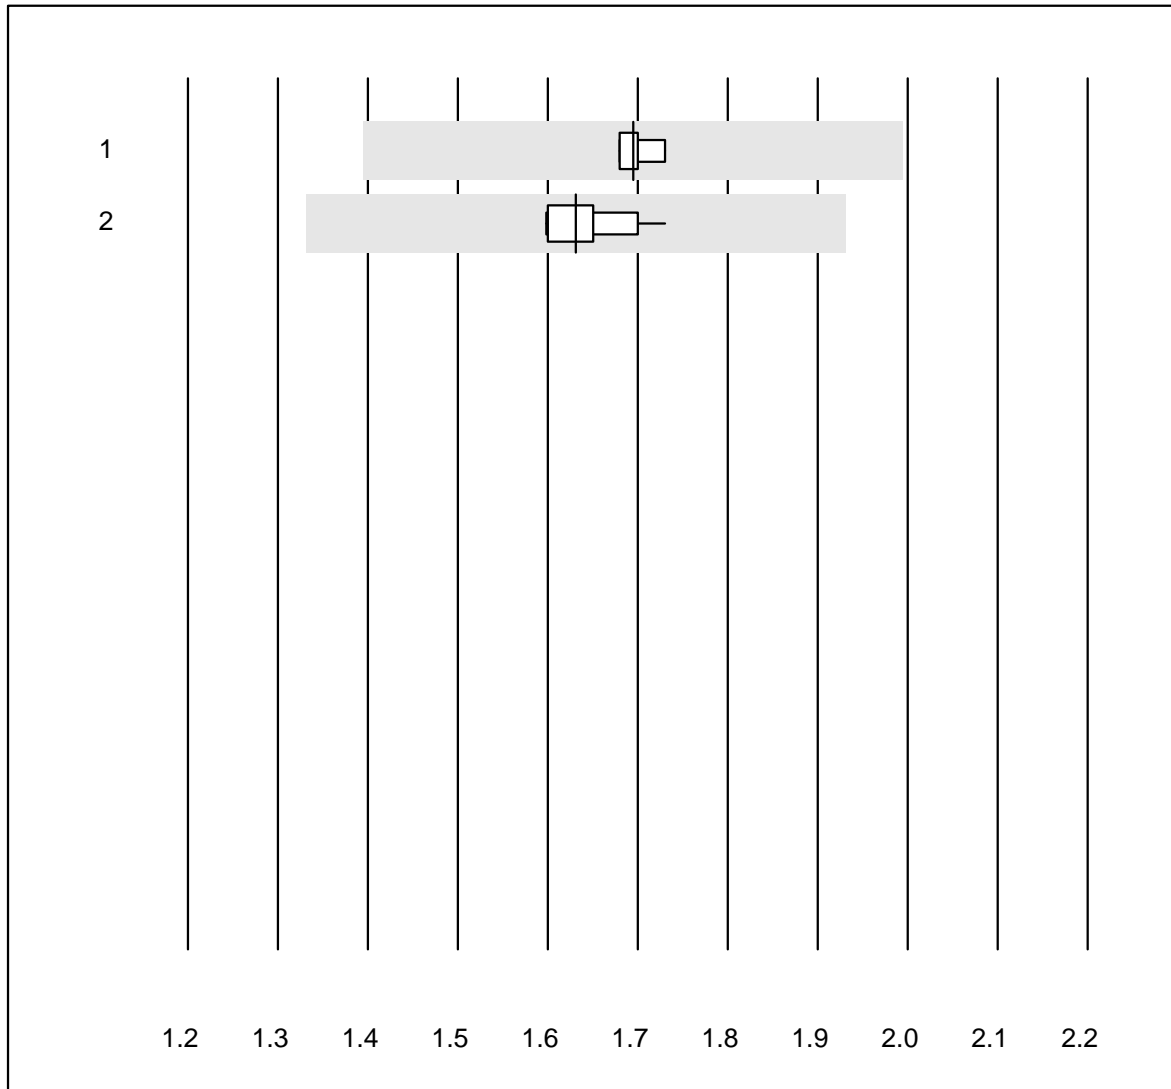


QUALAB Tolérance : 9 %  
( < 3.30: +/- 0.30 mmol/l)

Glucose CSF (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	1.70	1.3	e
2 Autres méthodes	10	100.0	0.0	0.0	1.63	2.9	e

## Lactate CSF

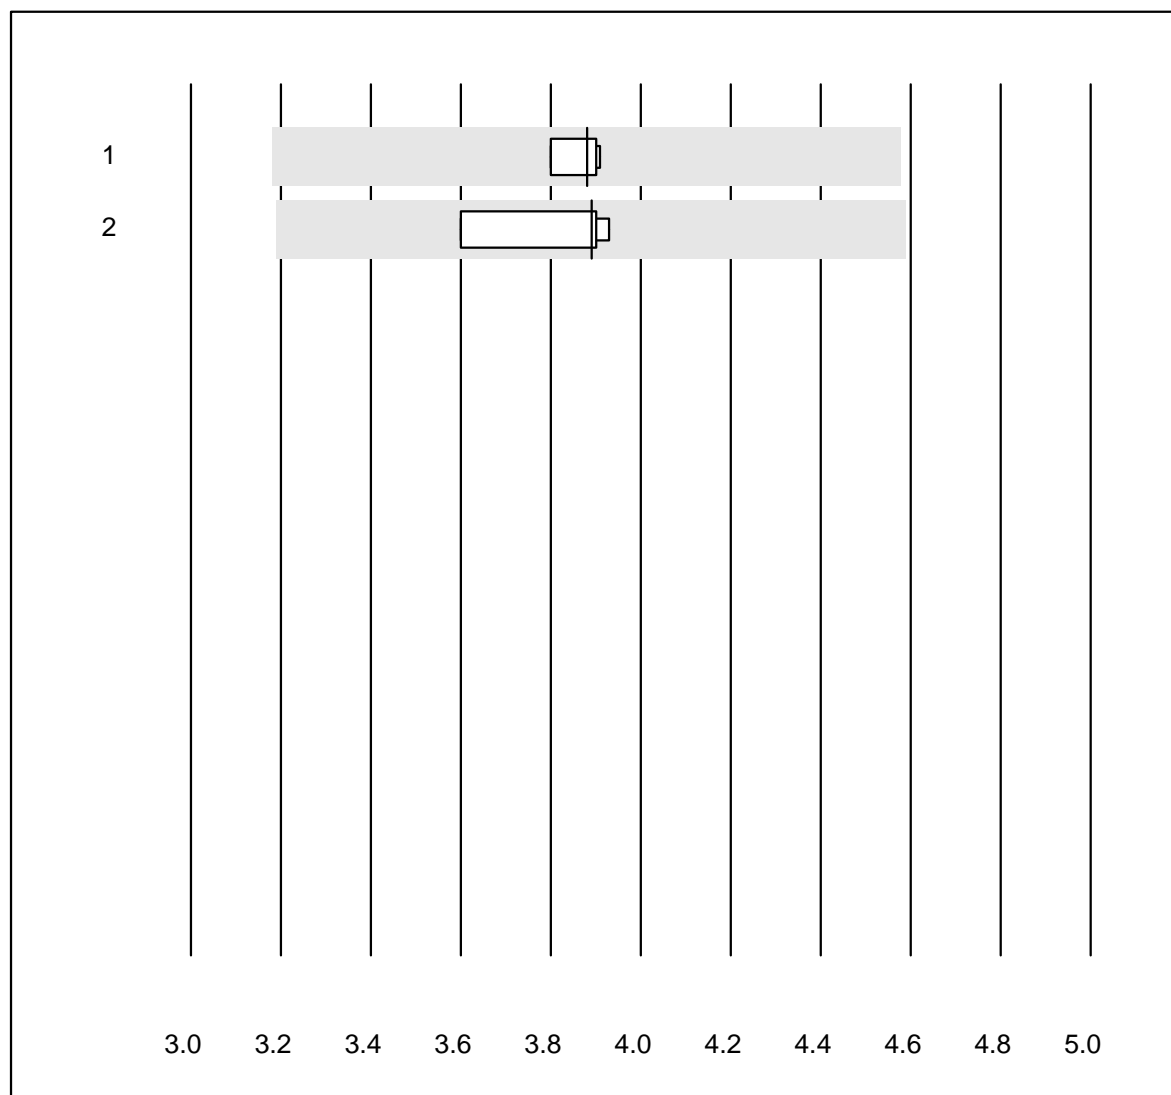


QUALAB Tolérance : 18 %

Lactate CSF (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	3.88	1.3	e
2 Autres méthodes	8	100.0	0.0	0.0	3.89	3.6	e

## Protéine CSF

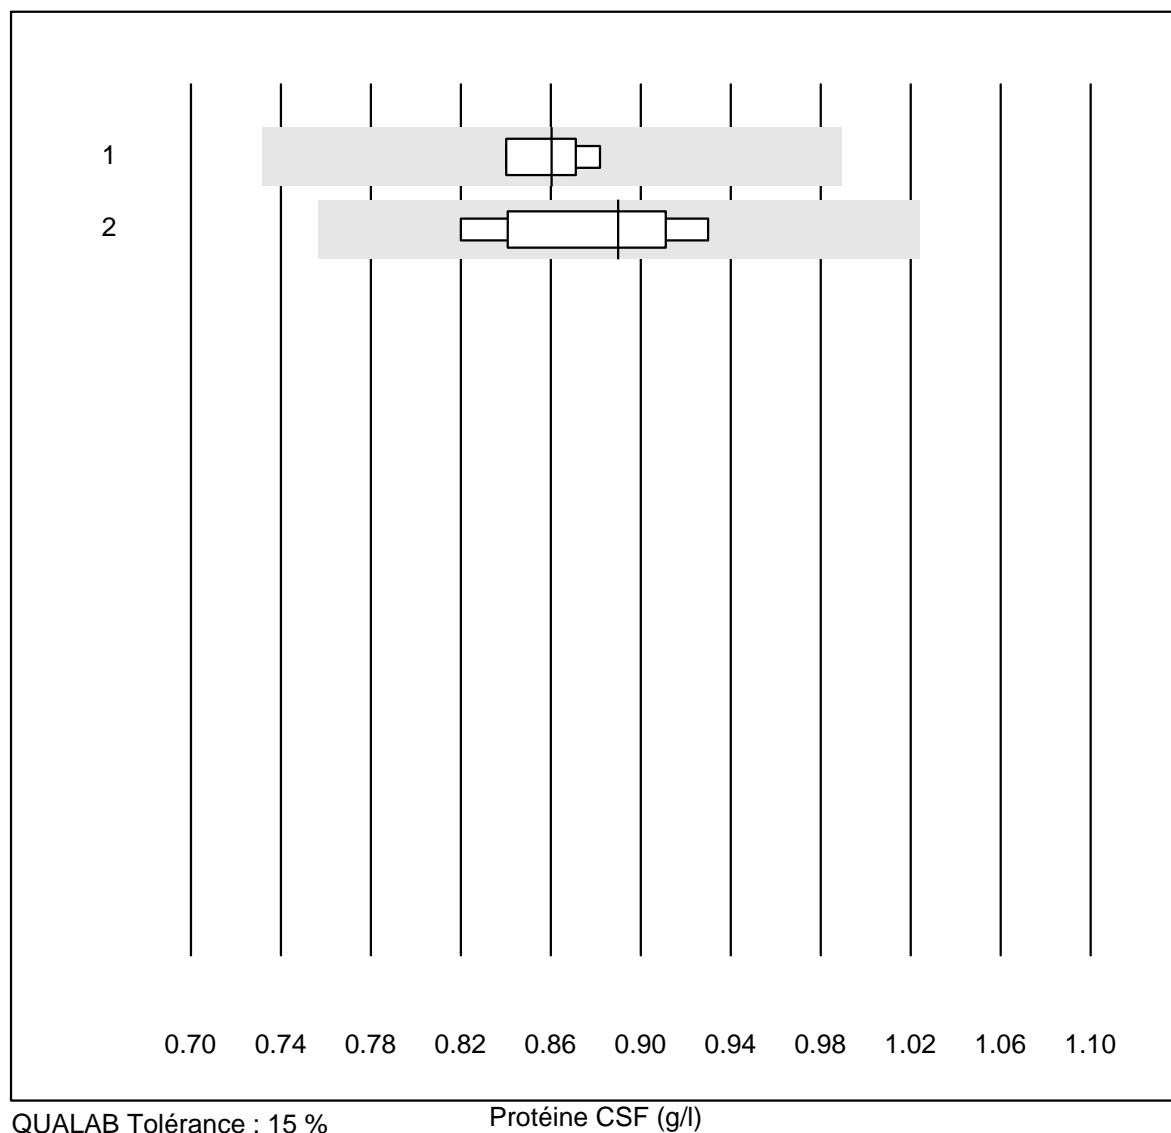


QUALAB Tolérance : 15 %

Protéine CSF (g/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	0.86	2.2	e
2 Autres méthodes	7	100.0	0.0	0.0	0.89	4.4	e

# CDT

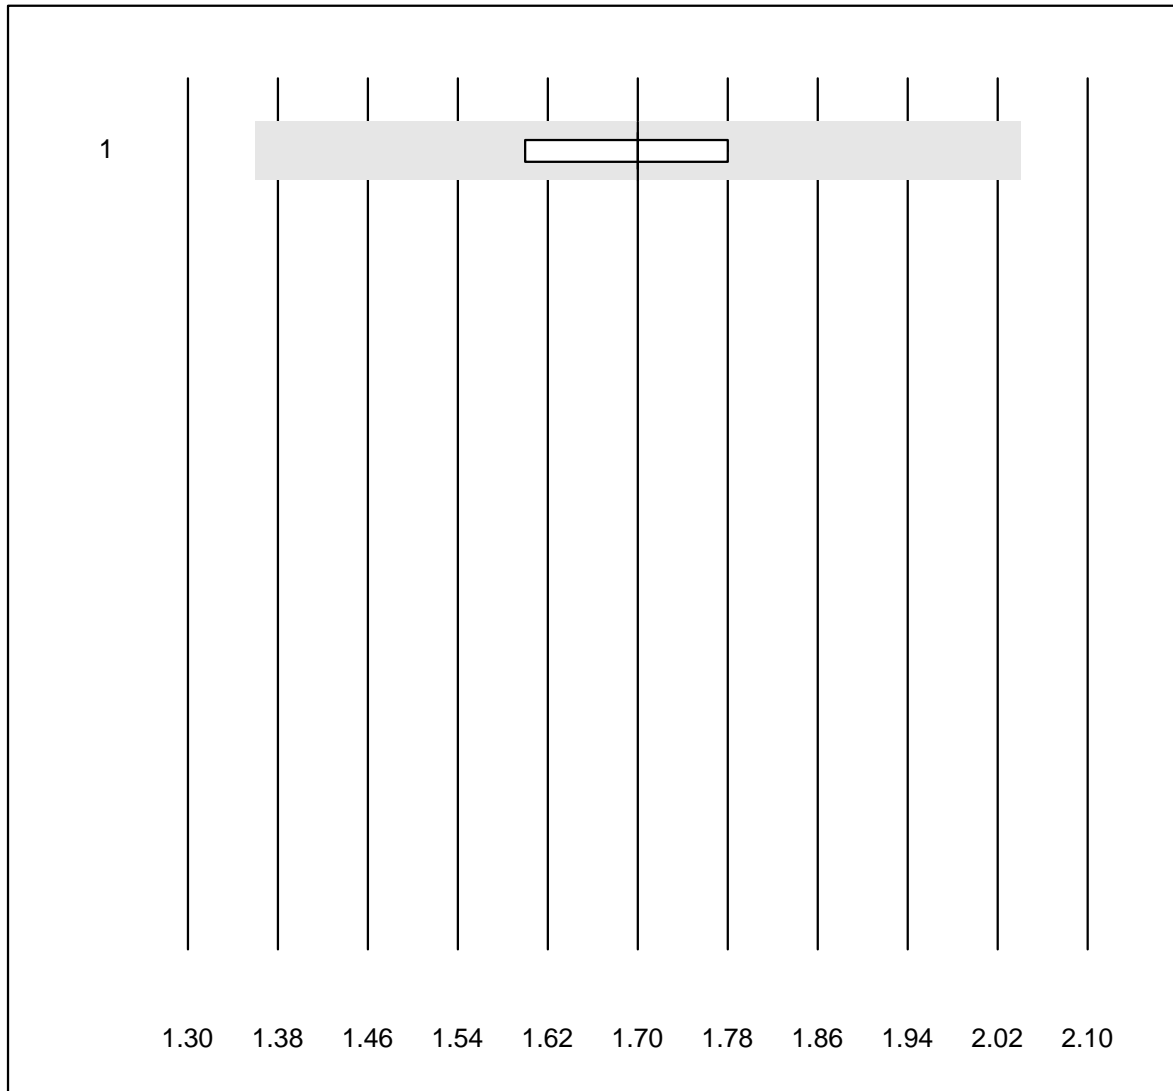


Tolérance MQ : 20 %

CDT (%)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	1.70	3.8	e



## Tacrolimus

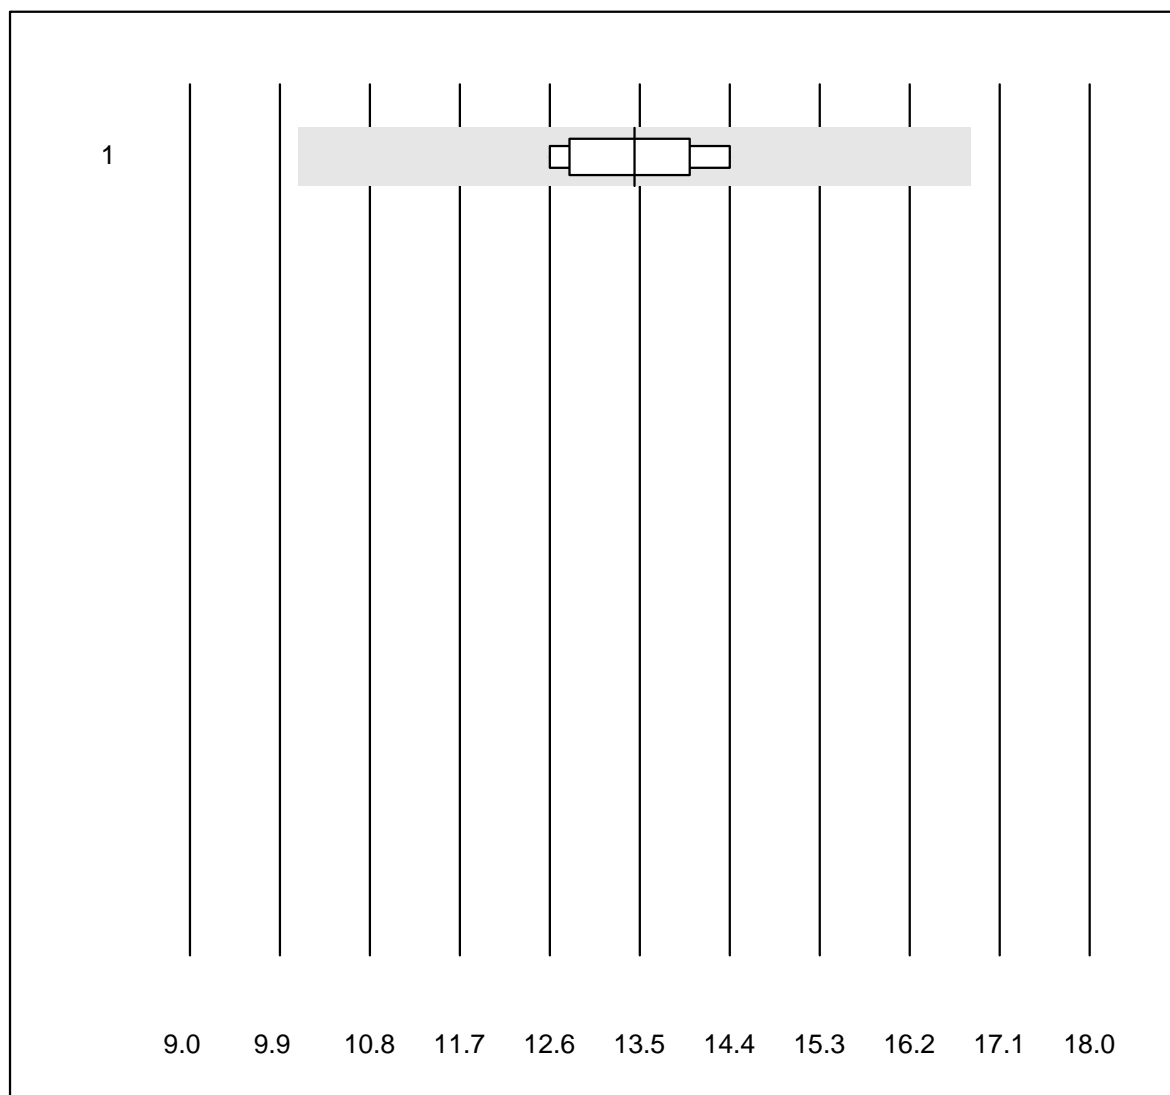


Tolérance MQ : 25 %

Tacrolimus (µg/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	8	100.0	0.0	0.0	13.4	4.9	e

## Totalprotein E

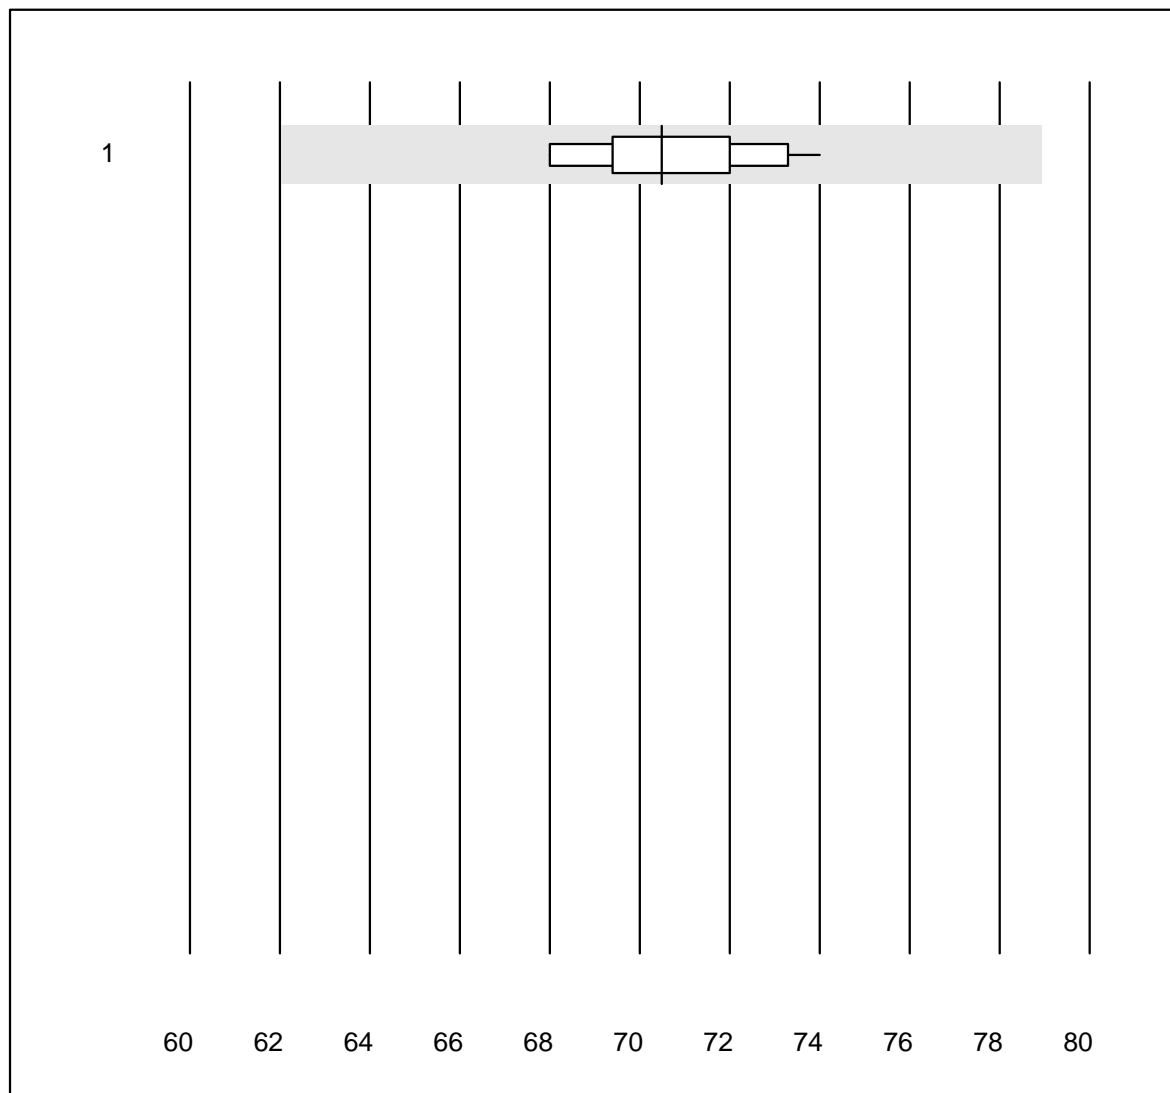


Tolérance MQ : 12 %

Totalprotein E (g/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	15	100.0	0.0	0.0	70.5	2.6	e

## Albumin E

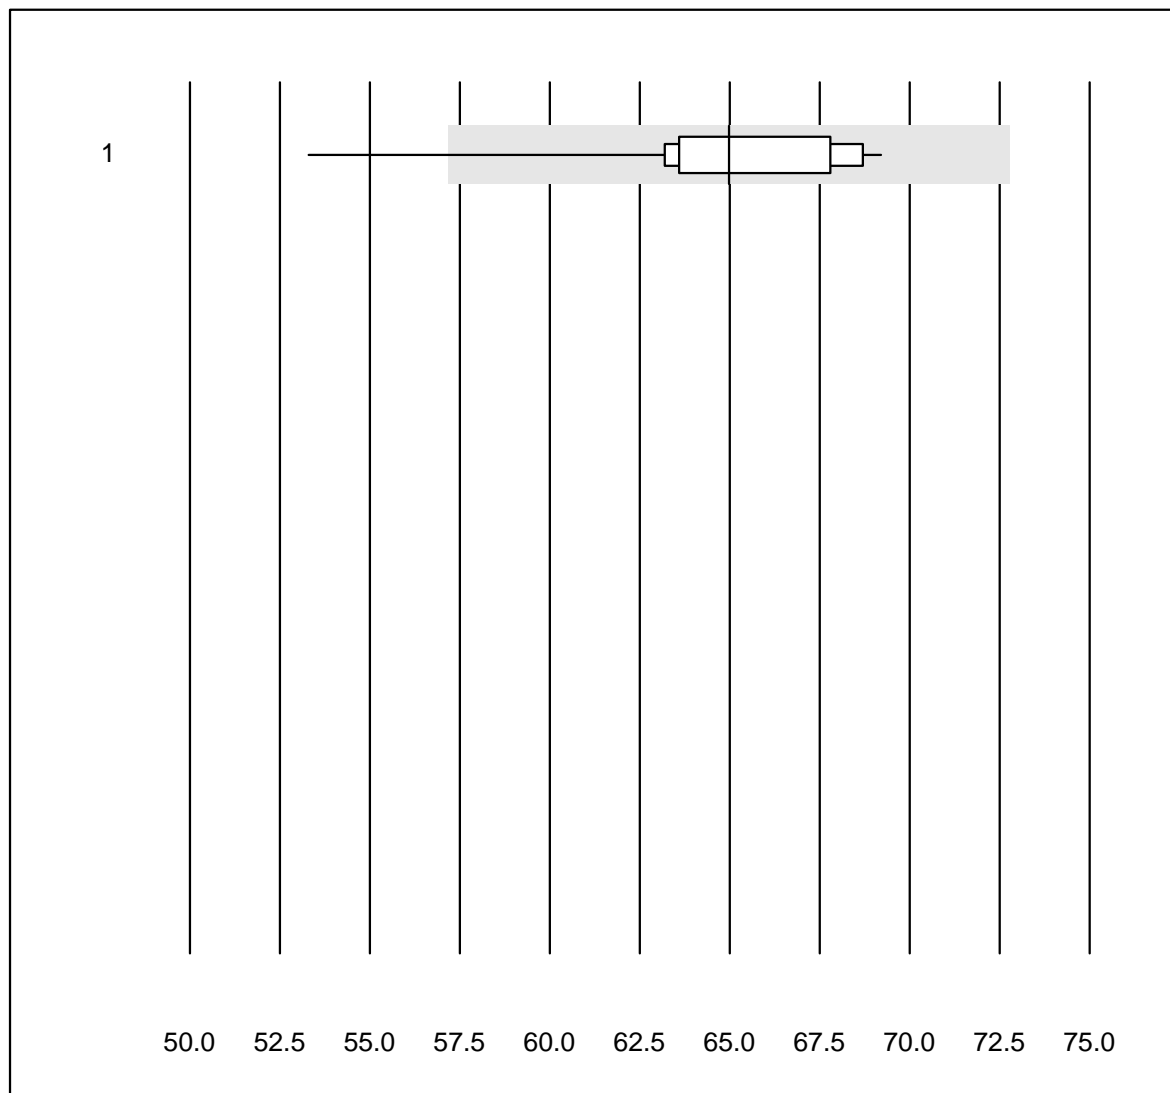


Tolérance MQ : 12 %

Albumin E (%)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 électrophorèse	22	91.0	4.5	4.5	65.0	5.4	e

## alpha-1-Globuline

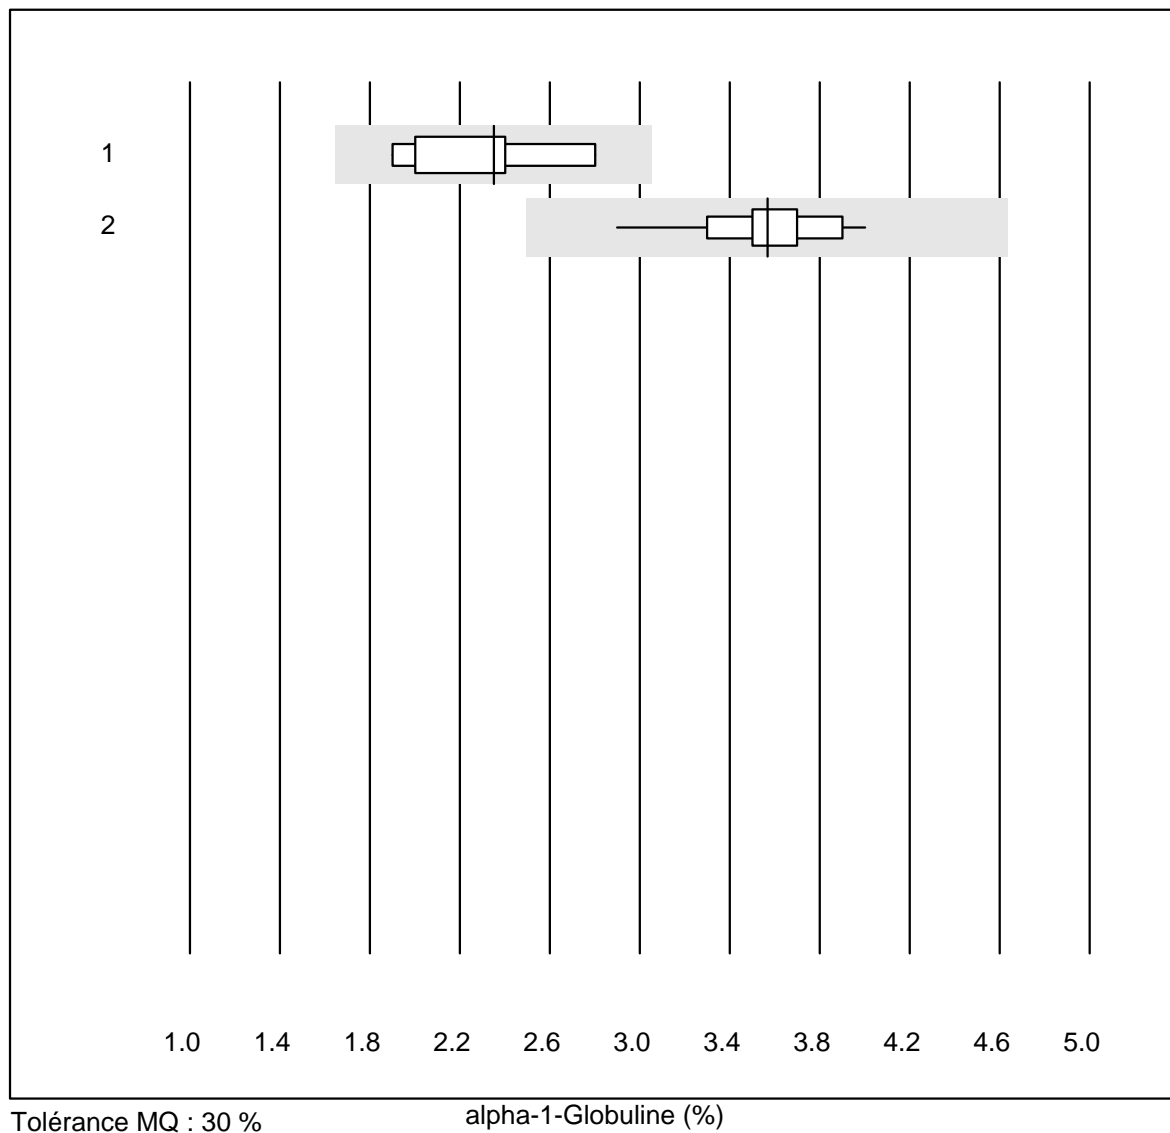


Tolérance MQ : 30 %

alpha-1-Globuline (%)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 électrophorèse	9	100.0	0.0	0.0	2.4	13.1	a
2 électrophorèse capil	12	100.0	0.0	0.0	3.6	8.0	e

## alpha-2-Globuline

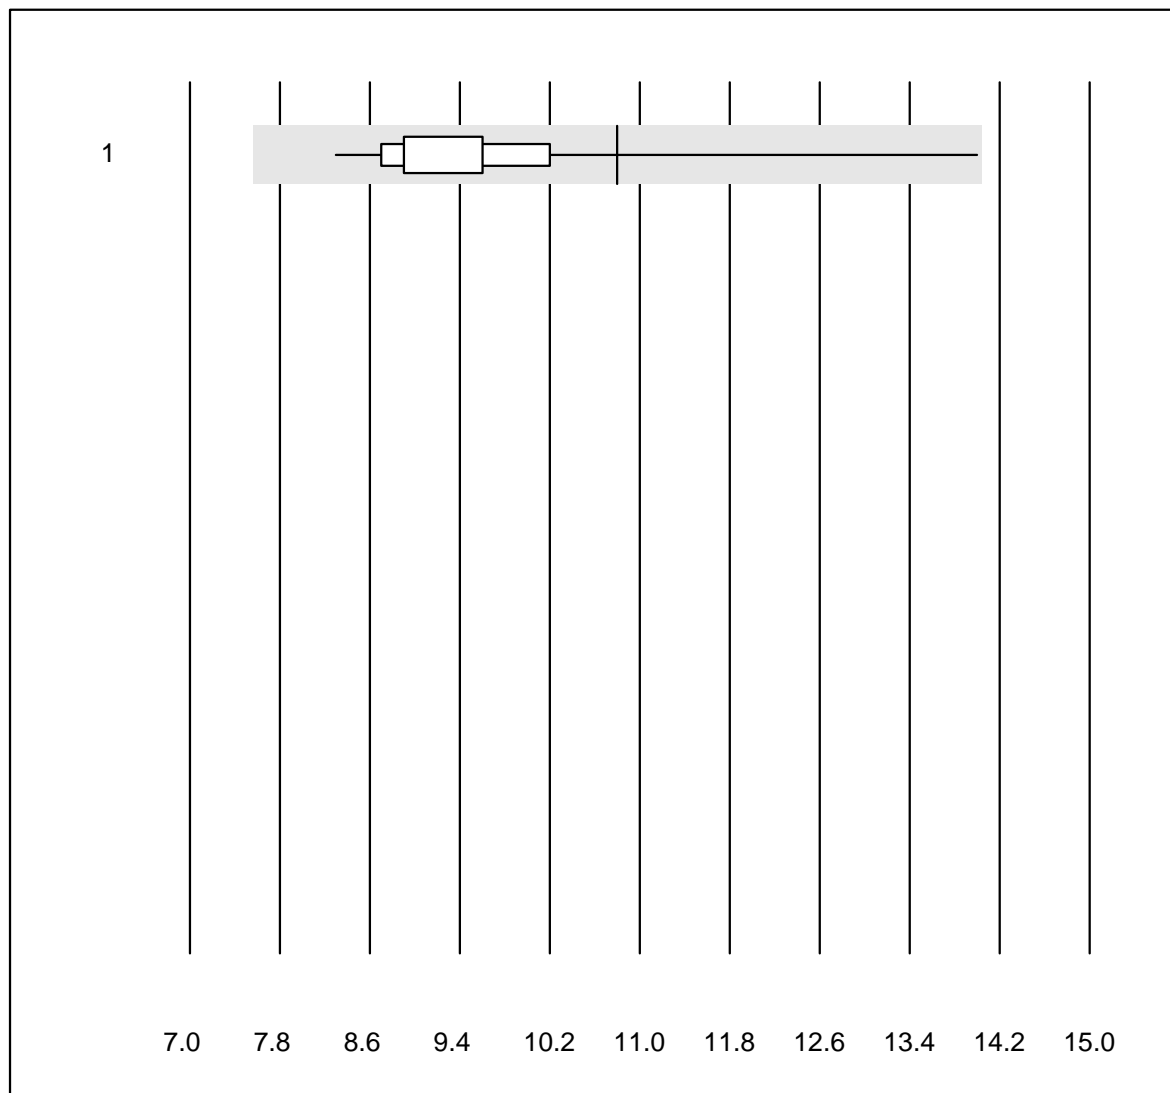


Tolérance MQ : 30 %

alpha-2-Globuline (%)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 électrophorèse	21	100.0	0.0	0.0	10.8	14.1	a

## beta-Globuline

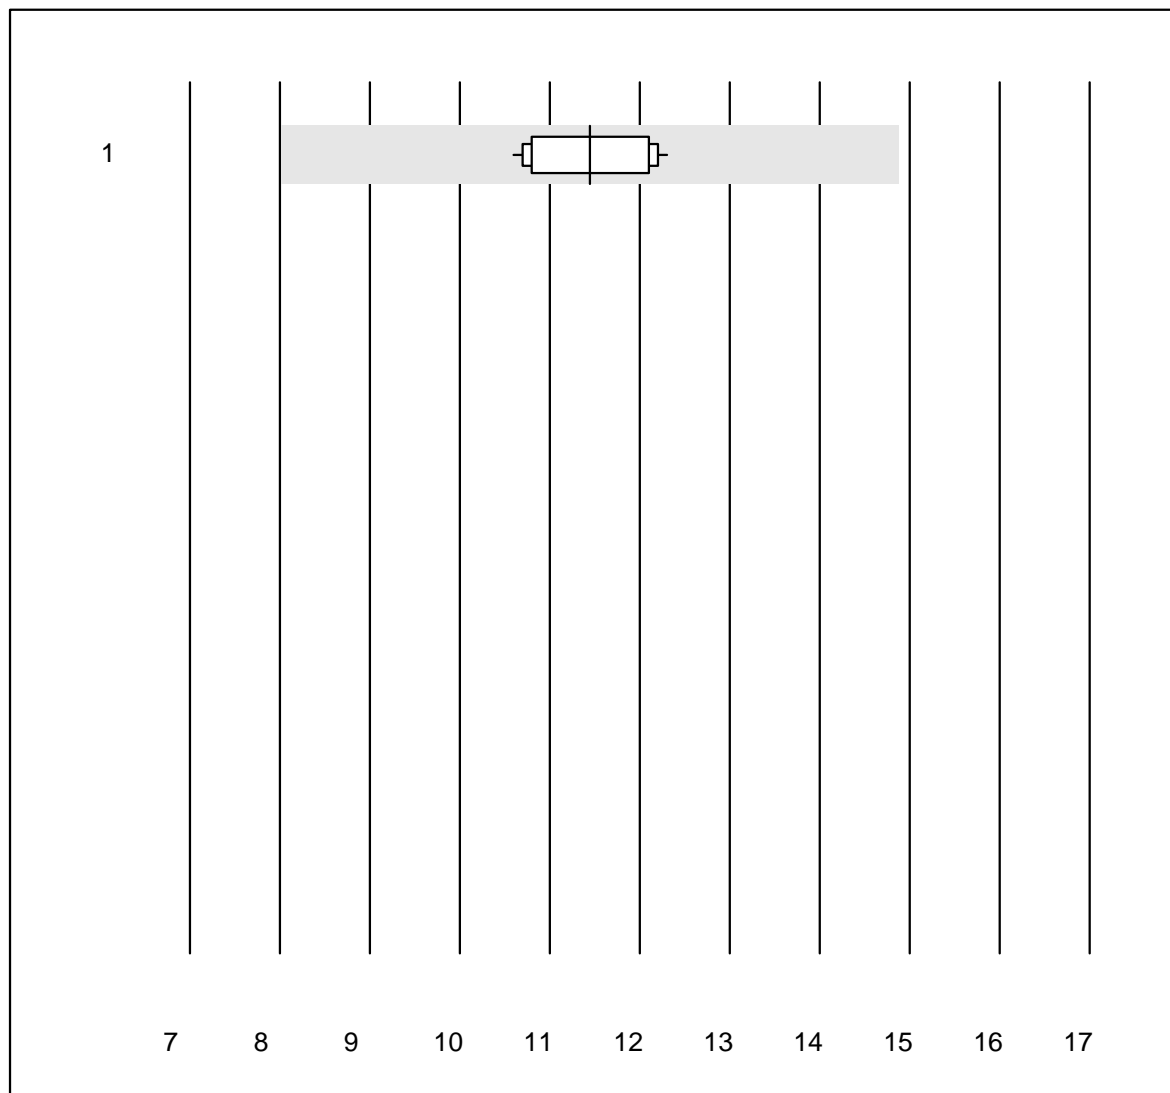


Tolérance MQ : 30 %

beta-Globuline (%)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 électrophorèse	16	93.7	0.0	6.3	11.4	5.3	e

## Beta-1-Globulin

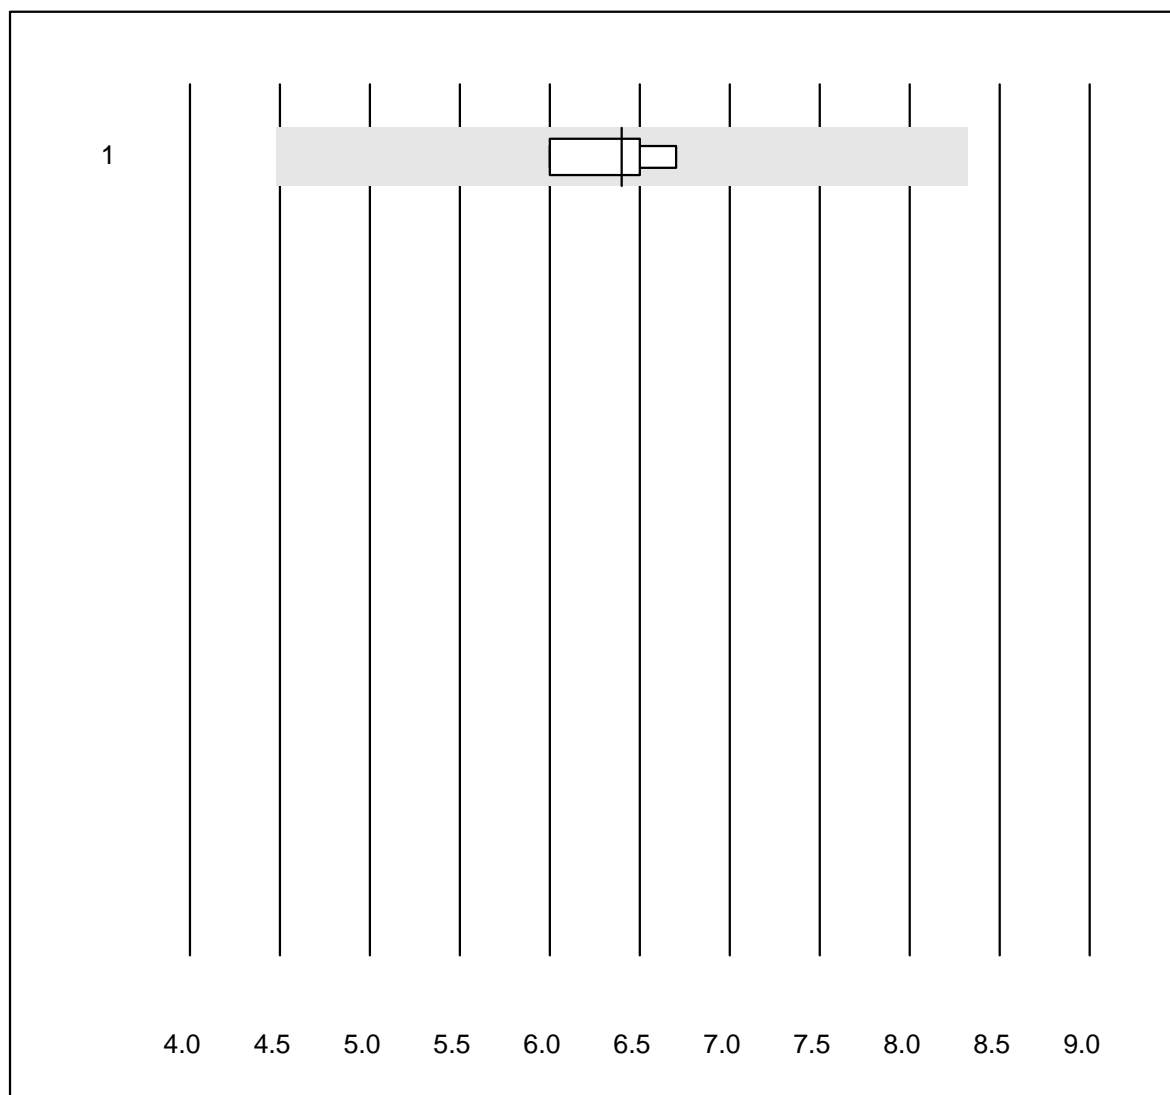


Tolérance MQ : 30 %

Beta-1-Globulin (%)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 électrophorèse	8	100.0	0.0	0.0	6.4	4.2	e

## Beta-2-Globulin

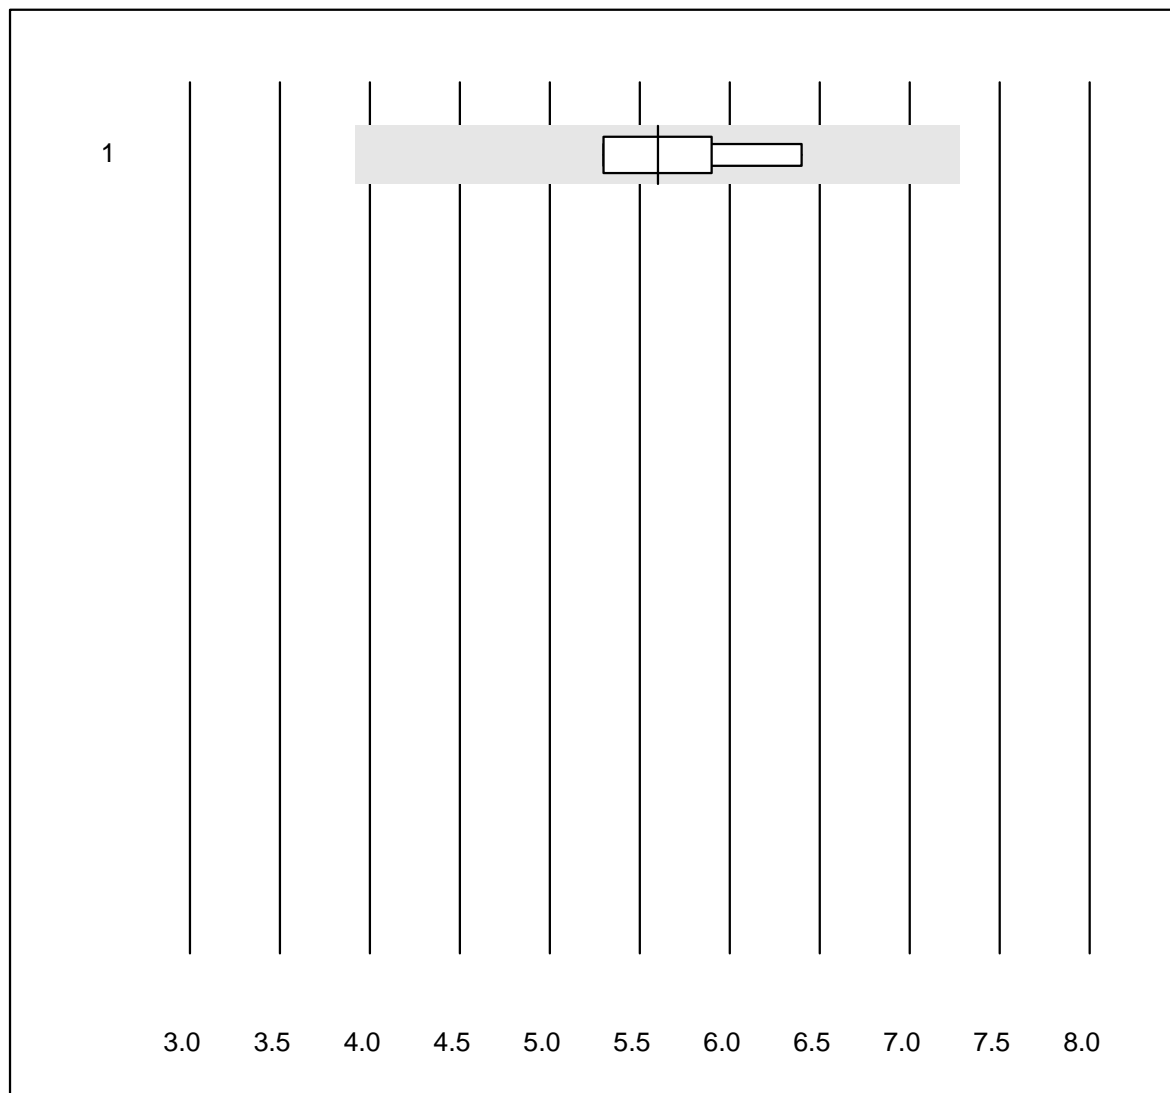


Tolérance MQ : 30 %

Beta-2-Globulin (%)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 électrophorèse	9	88.9	0.0	11.1	5.6	6.7	e



## gamma-Globuline

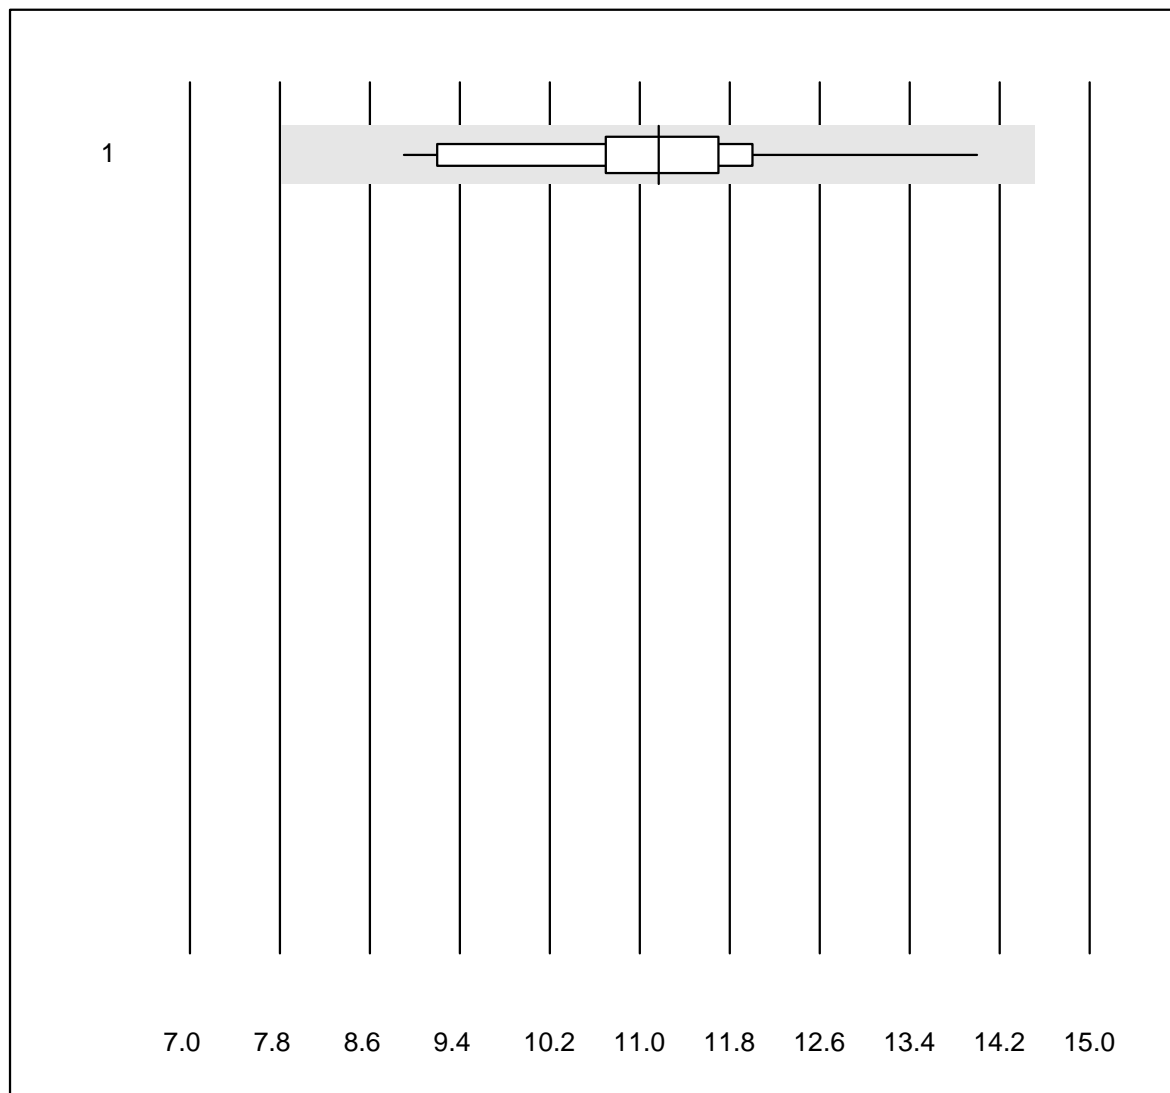


Tolérance MQ : 30 %

gamma-Globuline (%)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 électrophorèse	18	100.0	0.0	0.0	11.2	10.9	e

## Gamma-Globuline+P

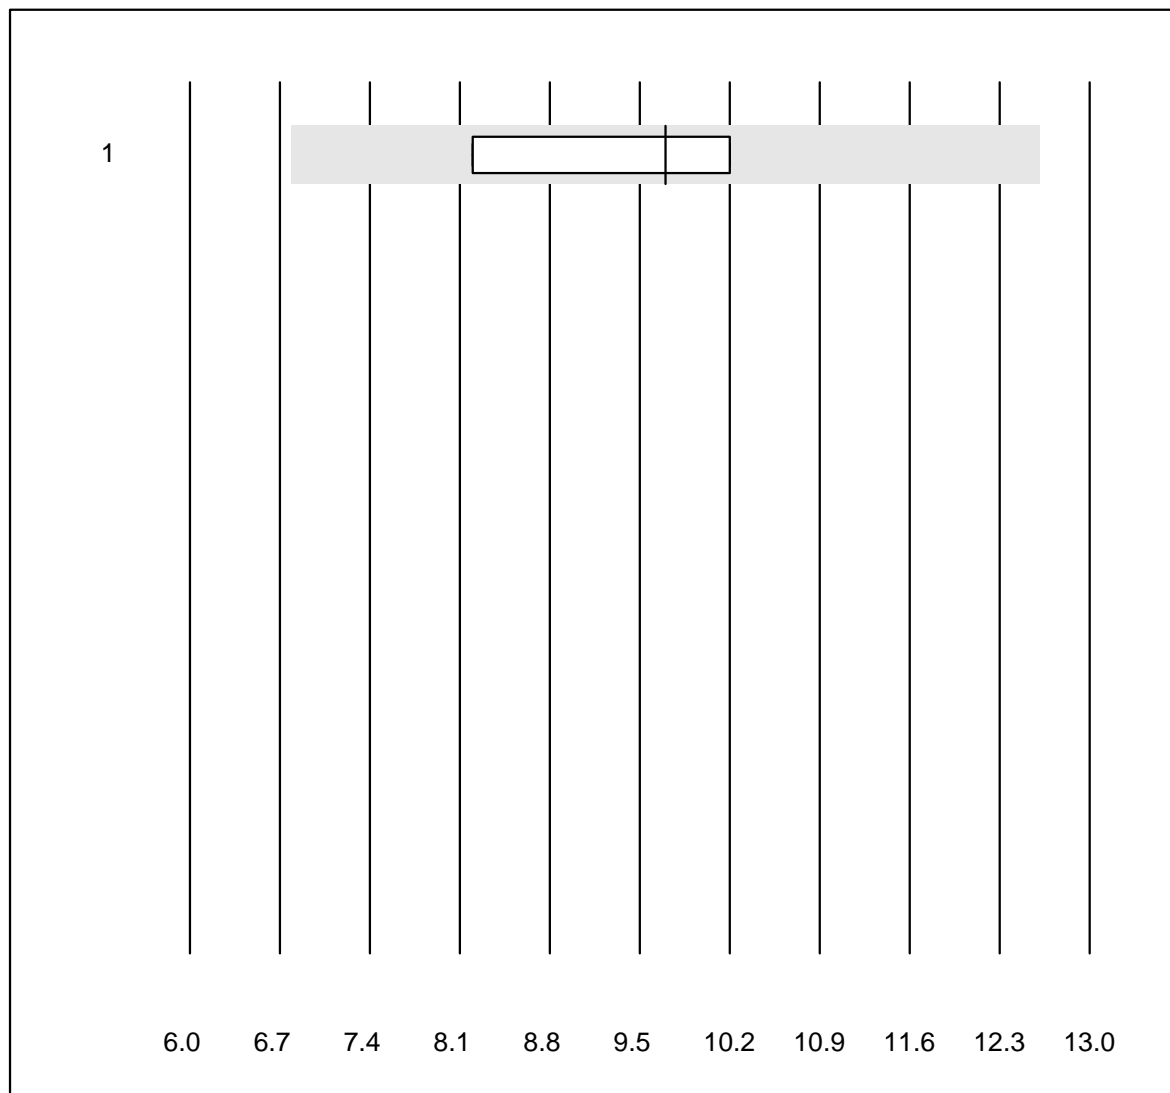


Tolérance MQ : 30 %

Gamma-Globuline+P (%)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 électrophorèse	4	100.0	0.0	0.0	9.7	10.1	e*

## Immunfixation

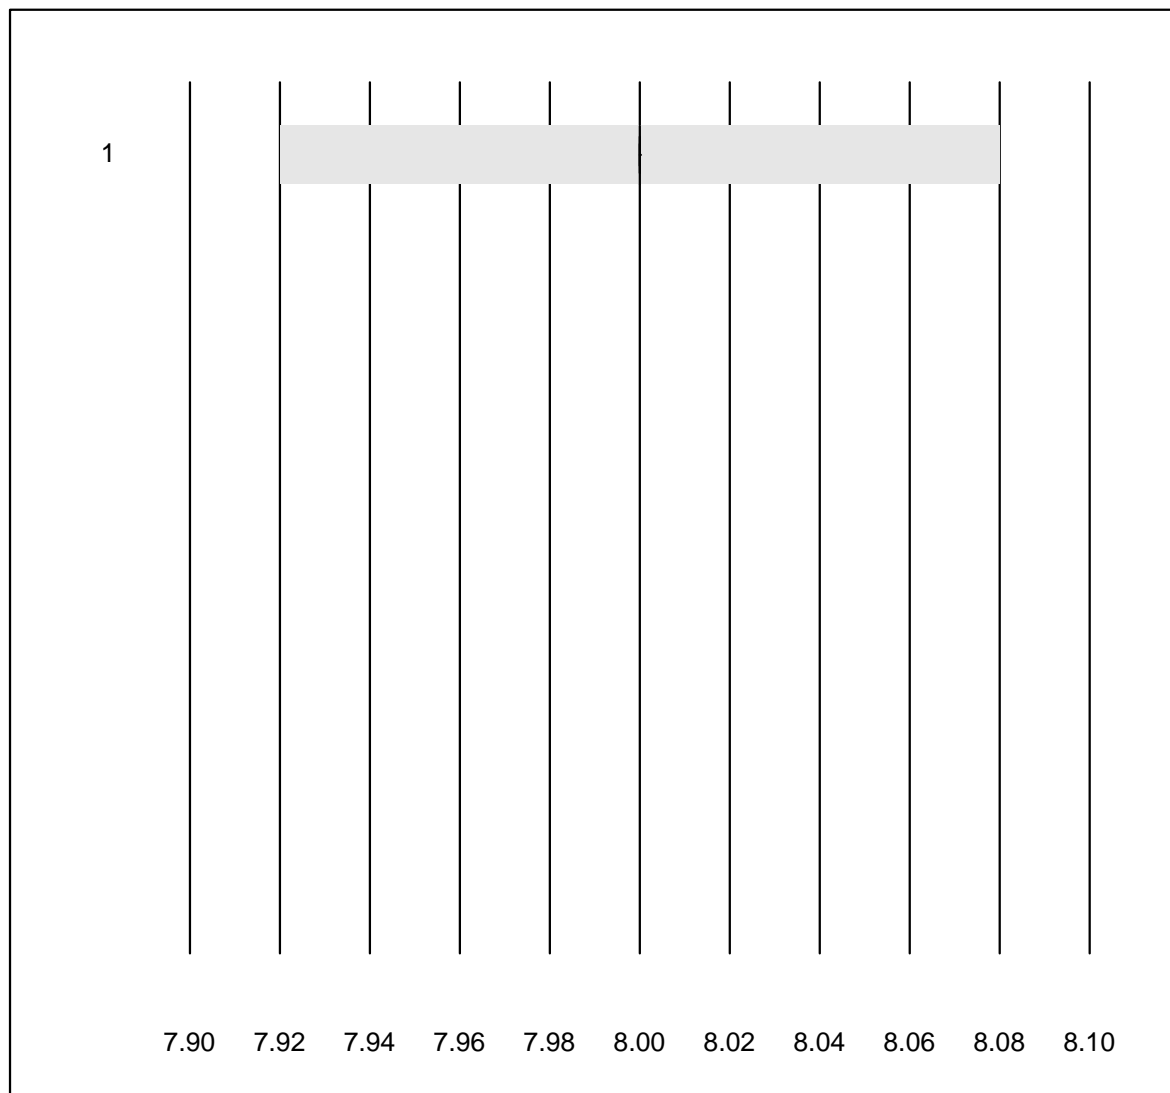


QUALAB Tolérance : 1 %

Immunfixation (Code)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 interprétation	17	100.0	0.0	0.0	8	0.0	e

## Folates érythrocytaires

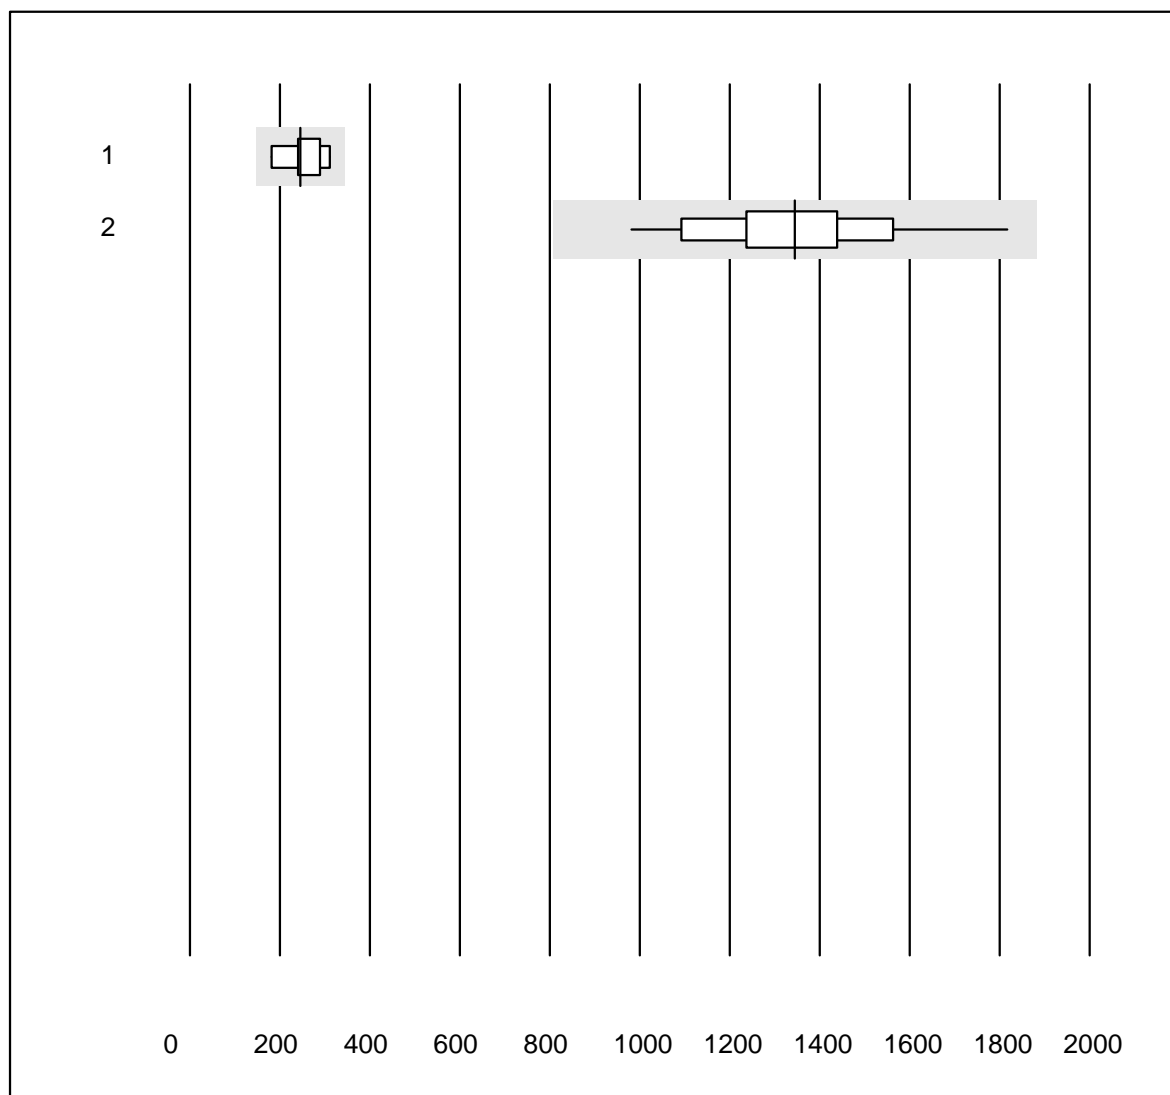


Tolérance MQ : 40 %

Folates érythrocytaires (nmol/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Architect	7	100.0	0.0	0.0	246	16.1	a
2 Cobas	11	100.0	0.0	0.0	1344	16.8	e*

## Gallensäure

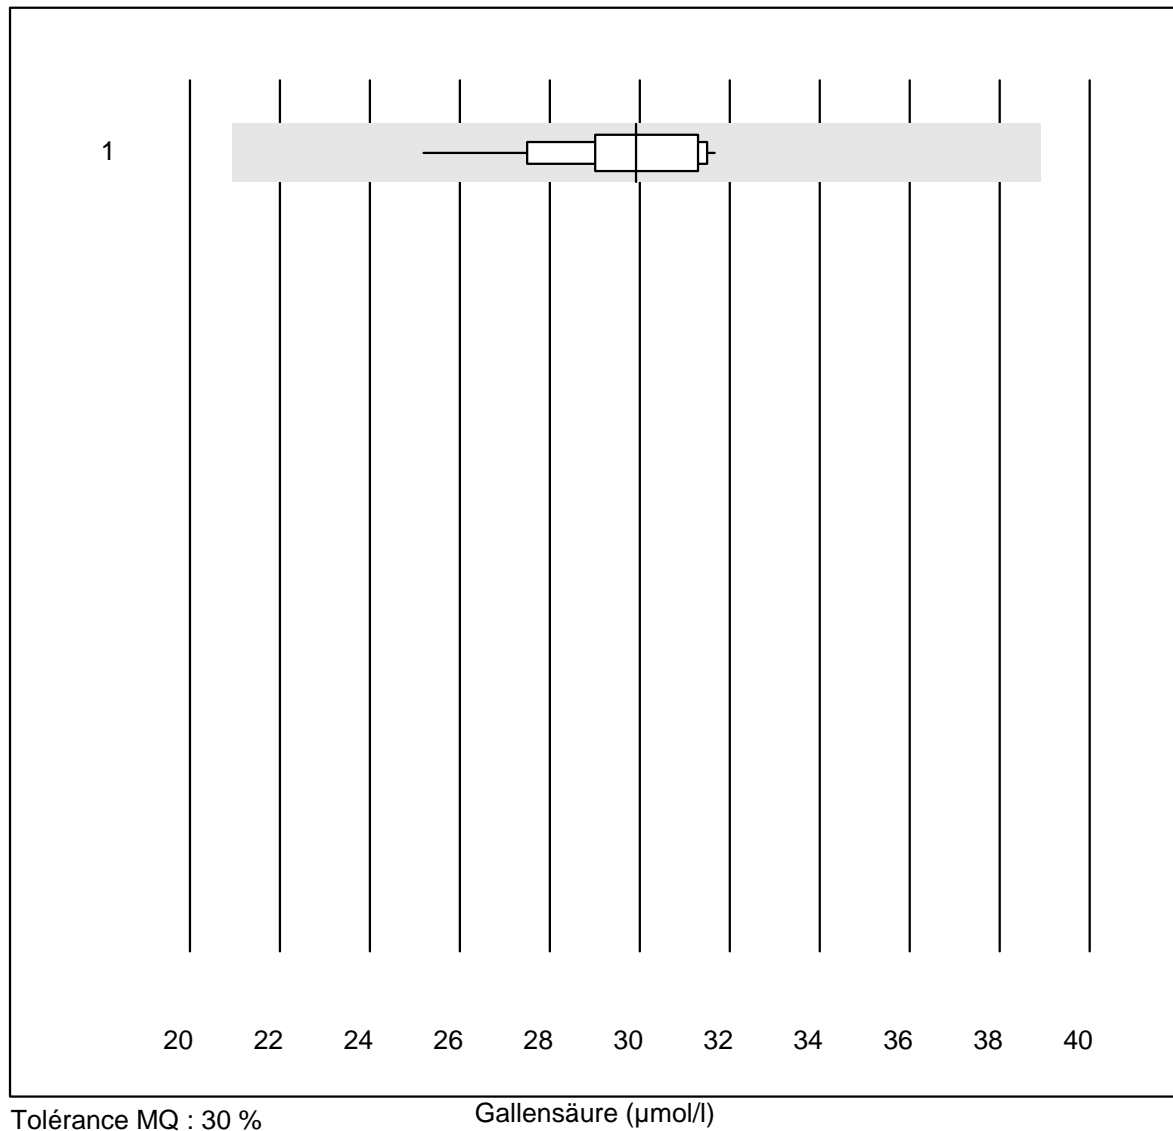

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	17	100.0	0.0	0.0	29.9	6.0	e

# BNP

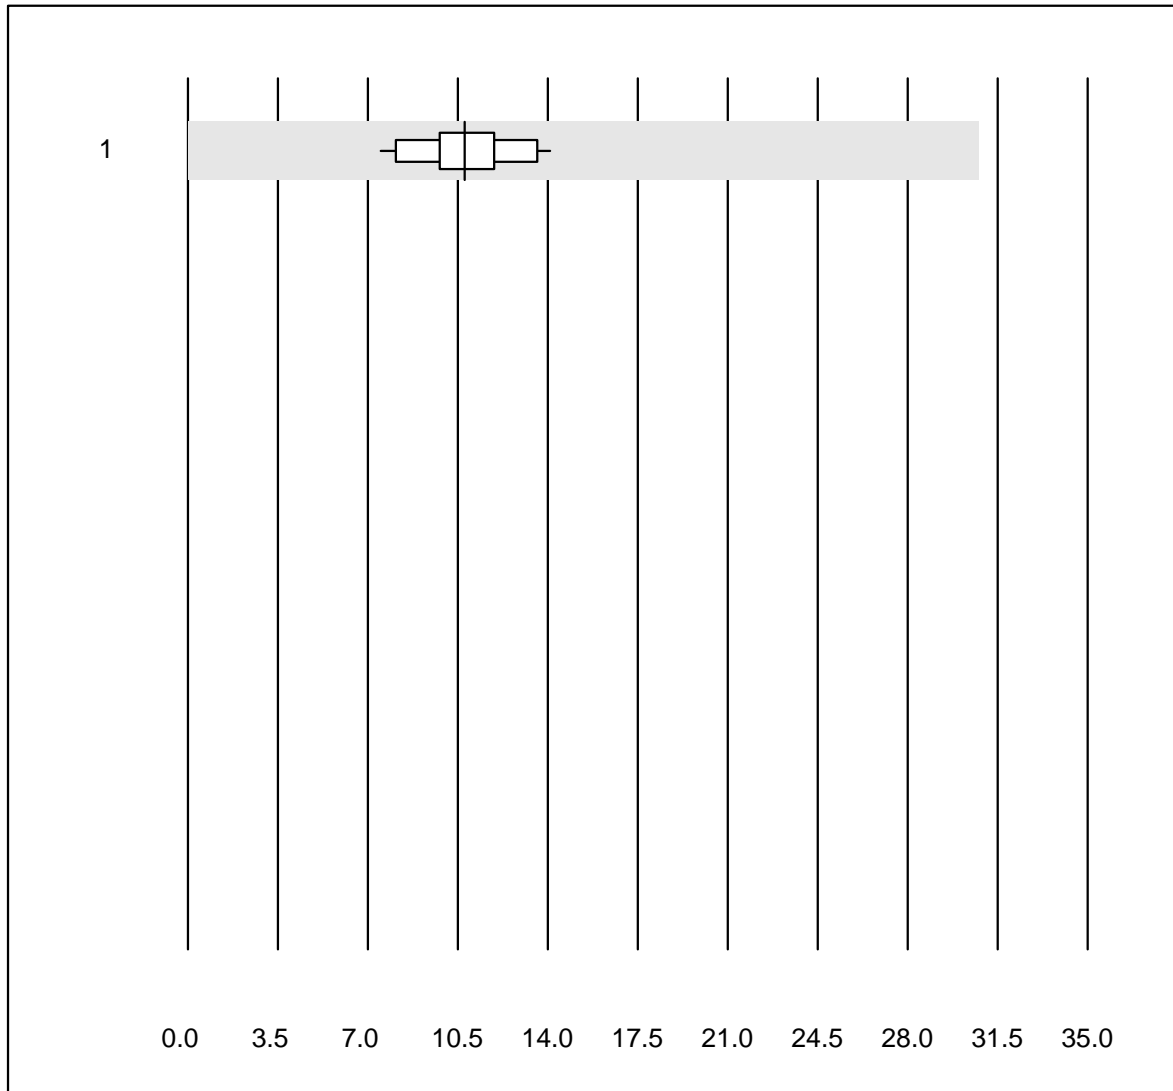


QUALAB Tolérance : 27 %  
 (< 75.0: +/- 20.0 ng/l)

BNP (ng/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Triage	17	82.4	0.0	17.6	10.8	17.8	e*

## Troponin Triage

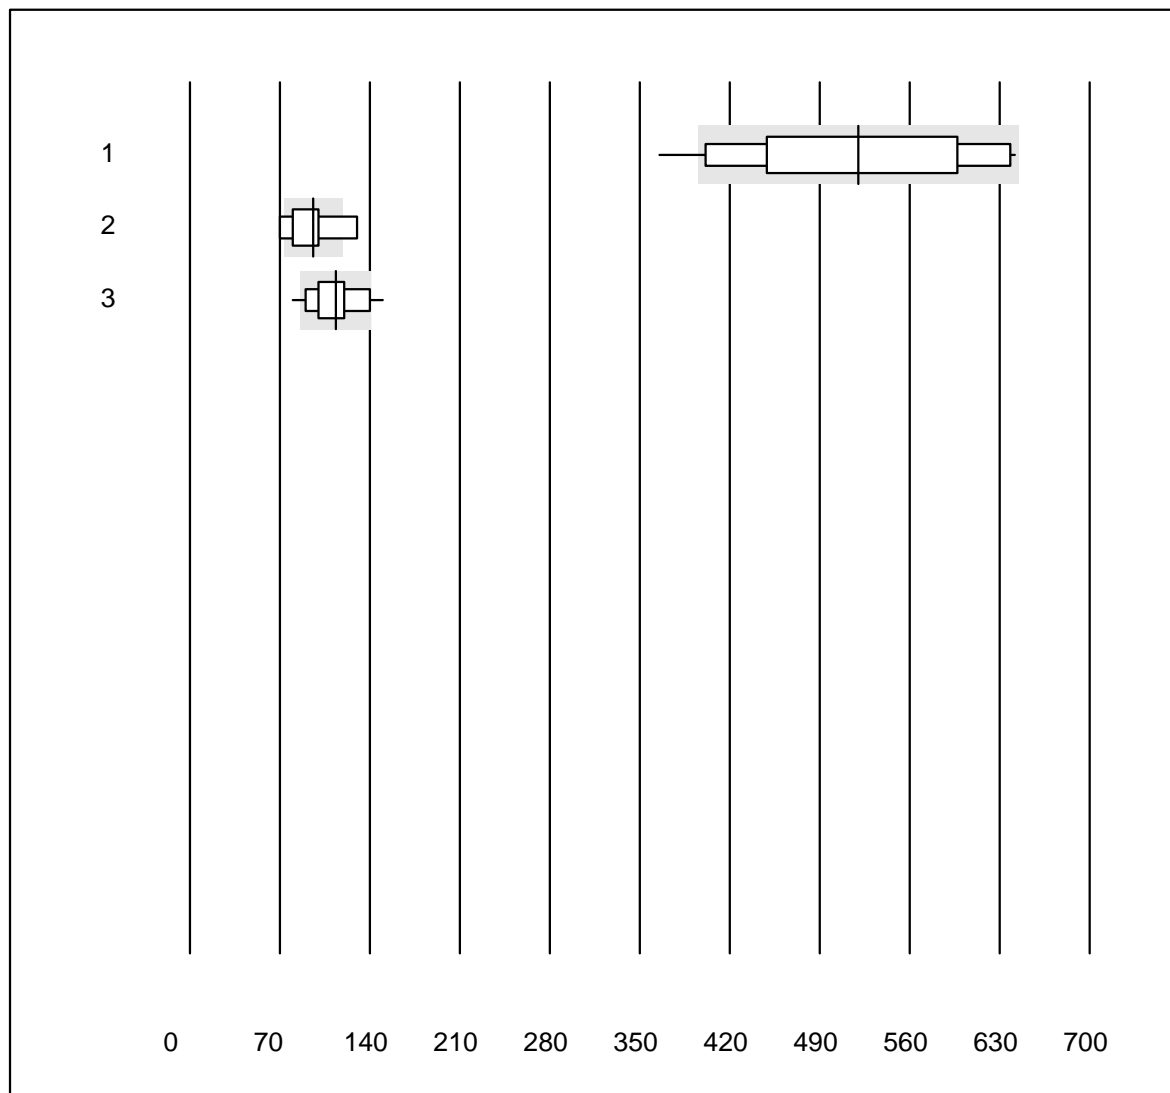


QUALAB Tolérance : 24 %

Troponin Triage (ng/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	Triage high sensitiv	20	90.0	5.0	5.0	520.00	16.0	a
2	Triage SOB/Cardiac	5	60.0	40.0	0.0	96.00	24.1	e*
3	Triage Next Gen	17	58.8	11.8	29.4	113.33	18.2	e*


## NT-pro BNP

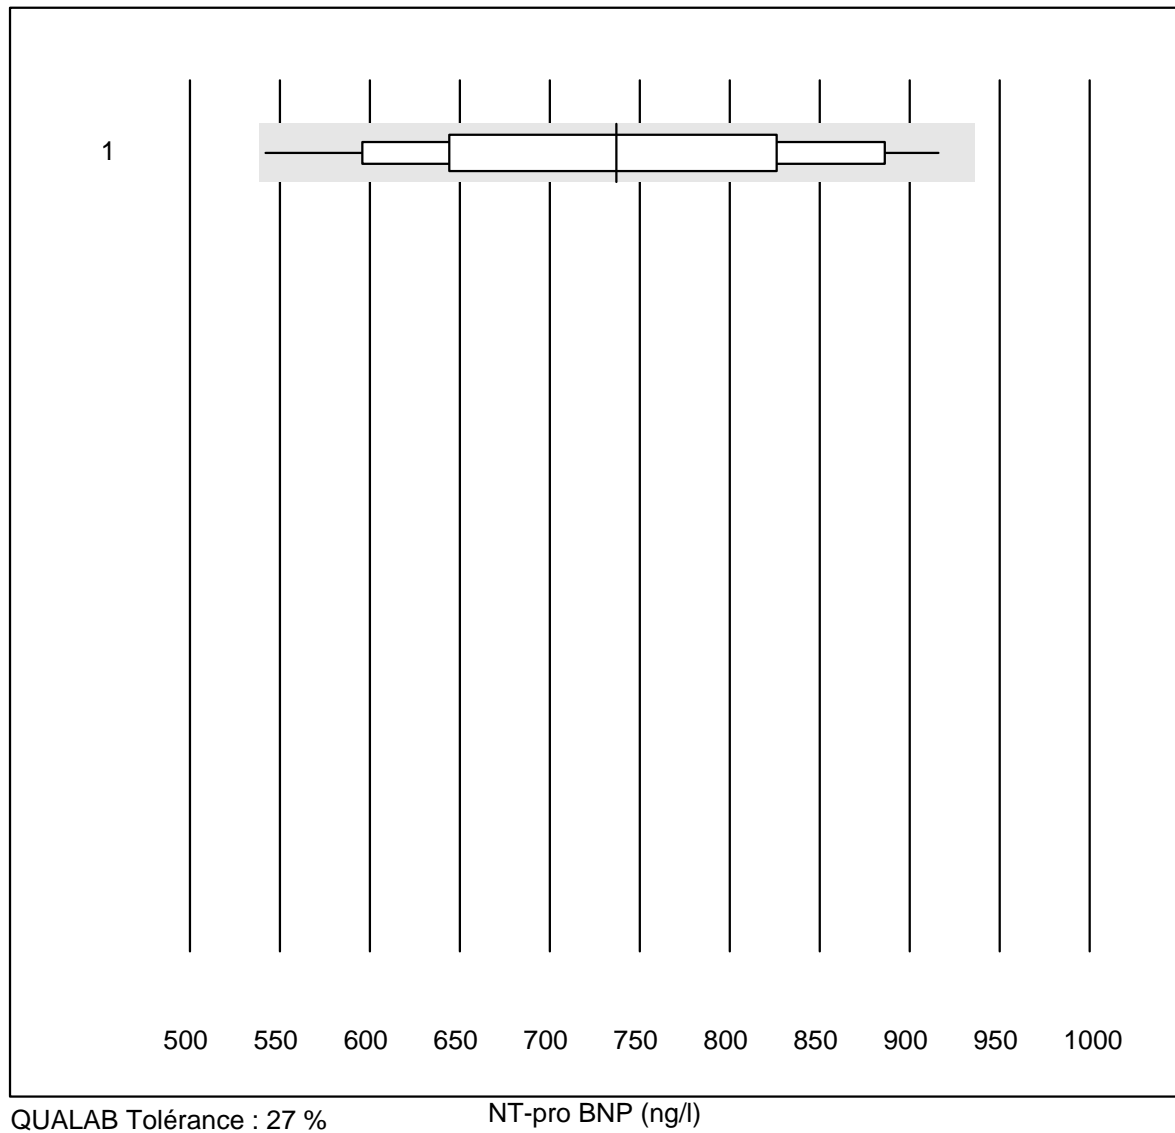

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Triage	13	92.3	0.0	7.7	737	16.3	e*




## D-Dimere Triage

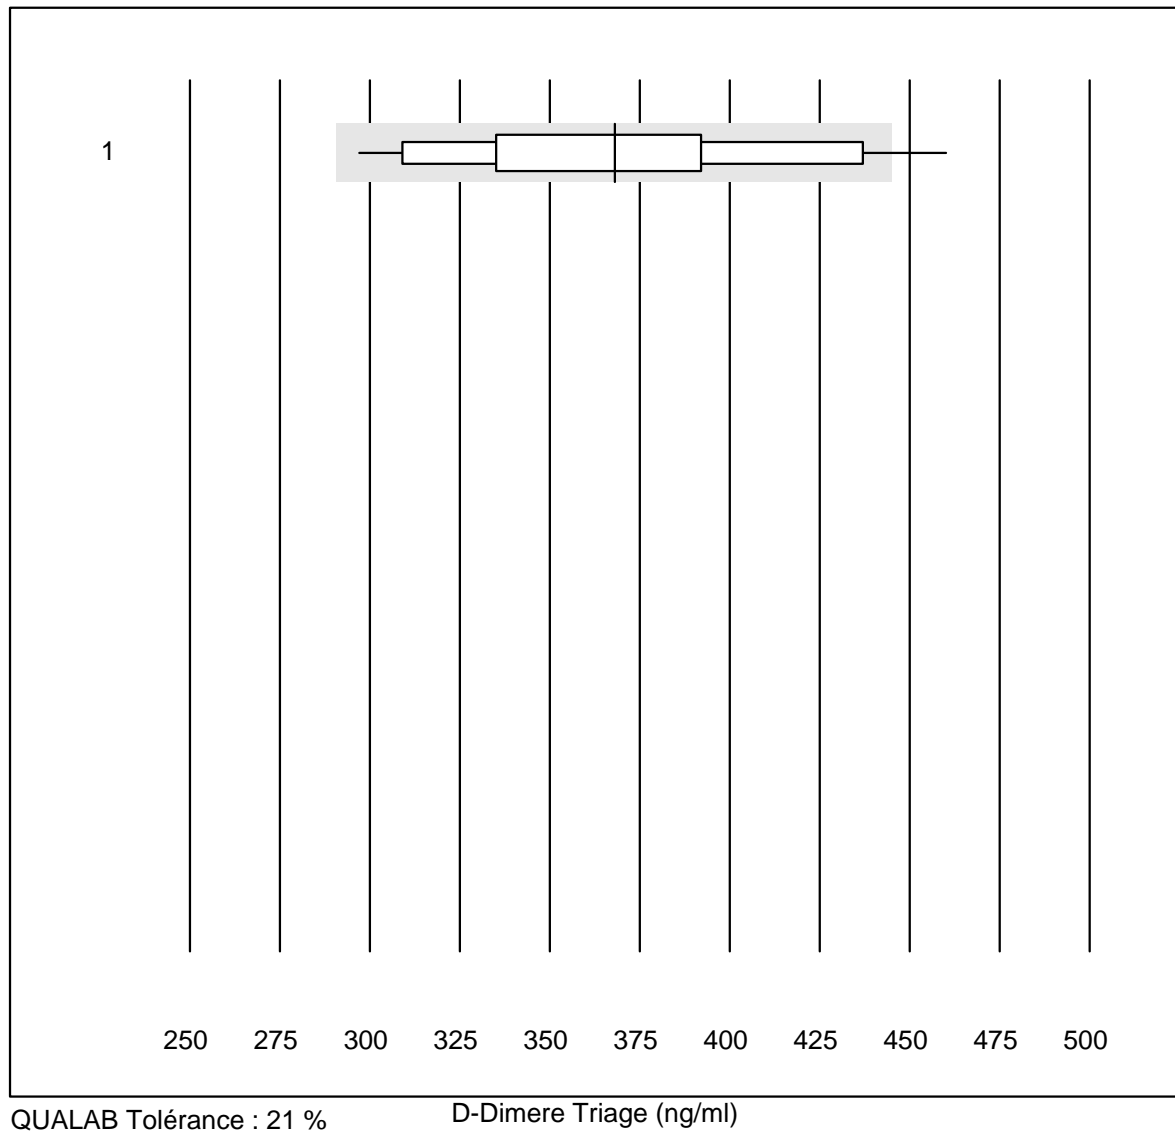


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Triage	38	84.2	2.6	13.2	367.97	12.8	e

## Vitamine D 25 (OH)

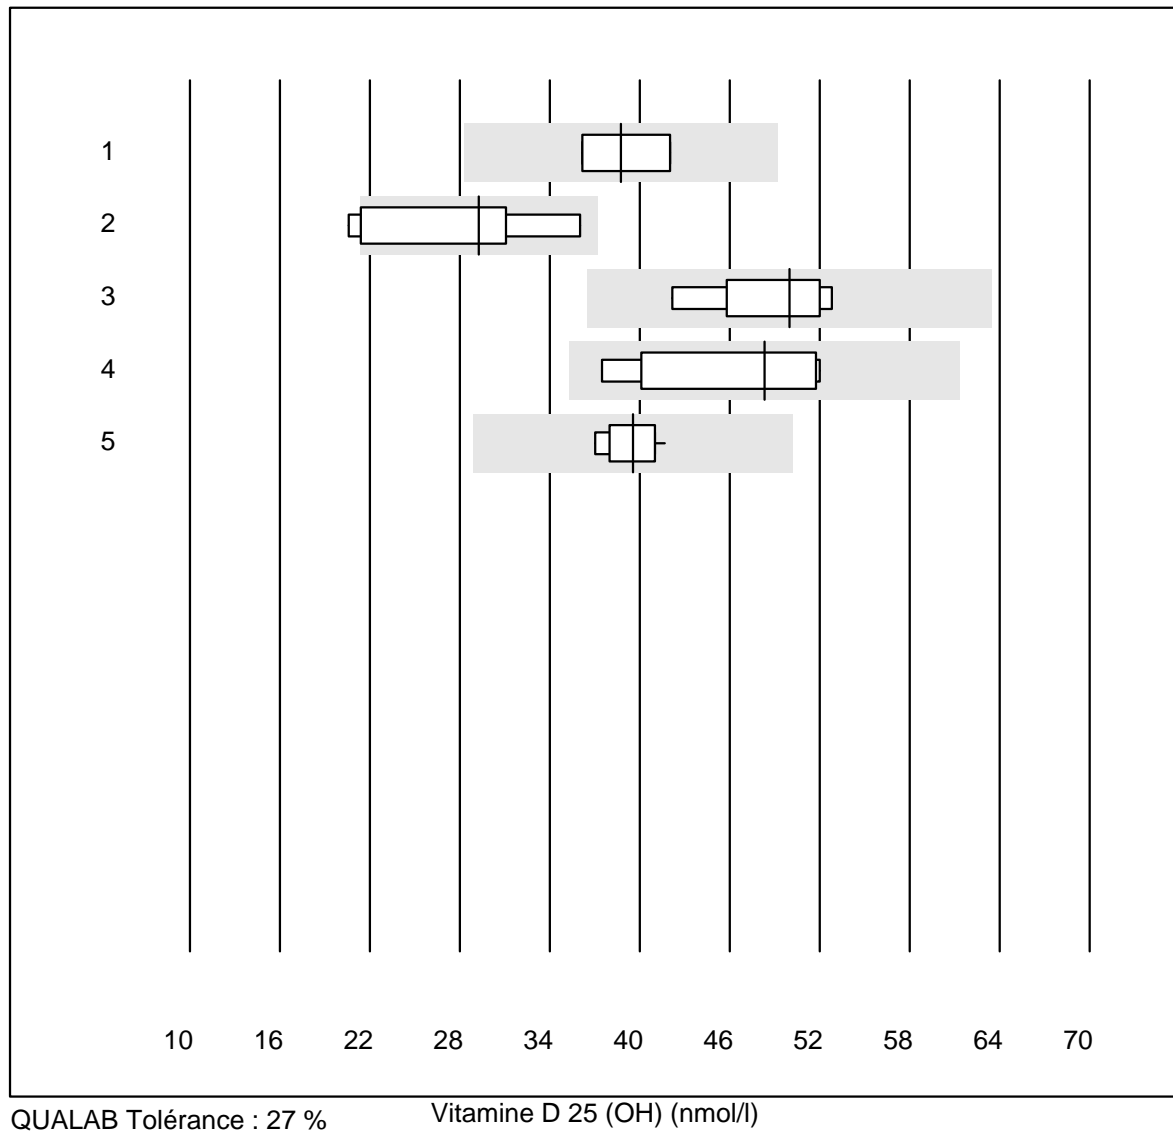


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 LCMS	4	75.0	0.0	25.0	38.7	7.7	a
2 Cobas	10	70.0	10.0	20.0	29.3	20.3	e*
3 VIDAS	7	100.0	0.0	0.0	50.0	7.6	a
4 Autres méthodes	11	63.6	0.0	36.4	48.3	13.5	a
5 Architect	10	100.0	0.0	0.0	39.6	4.3	e

## AMH

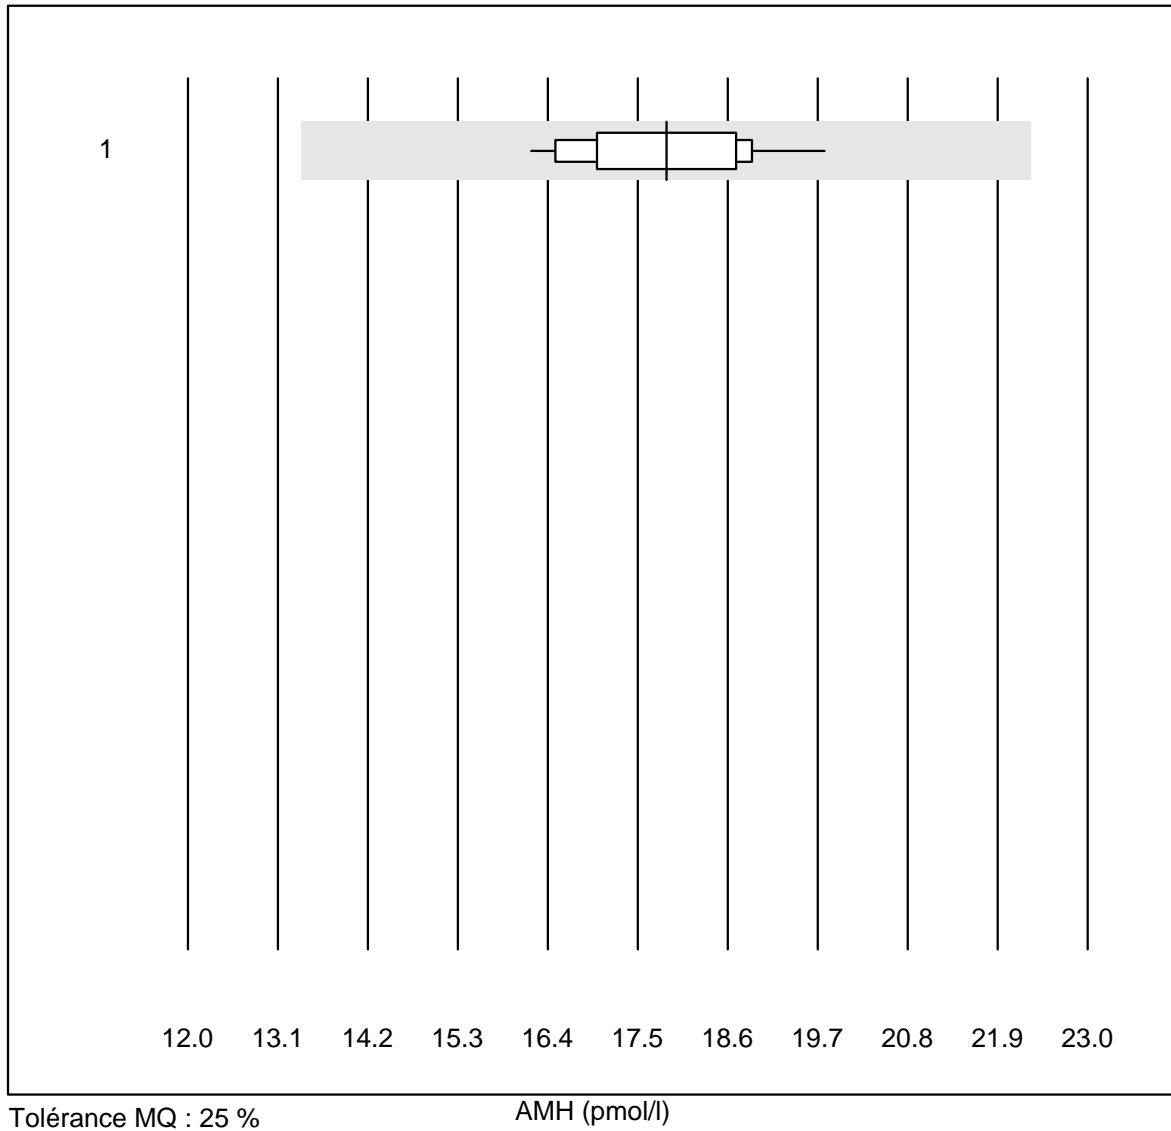

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	11	100.0	0.0	0.0	17.8	6.1	e

## Inhibin B

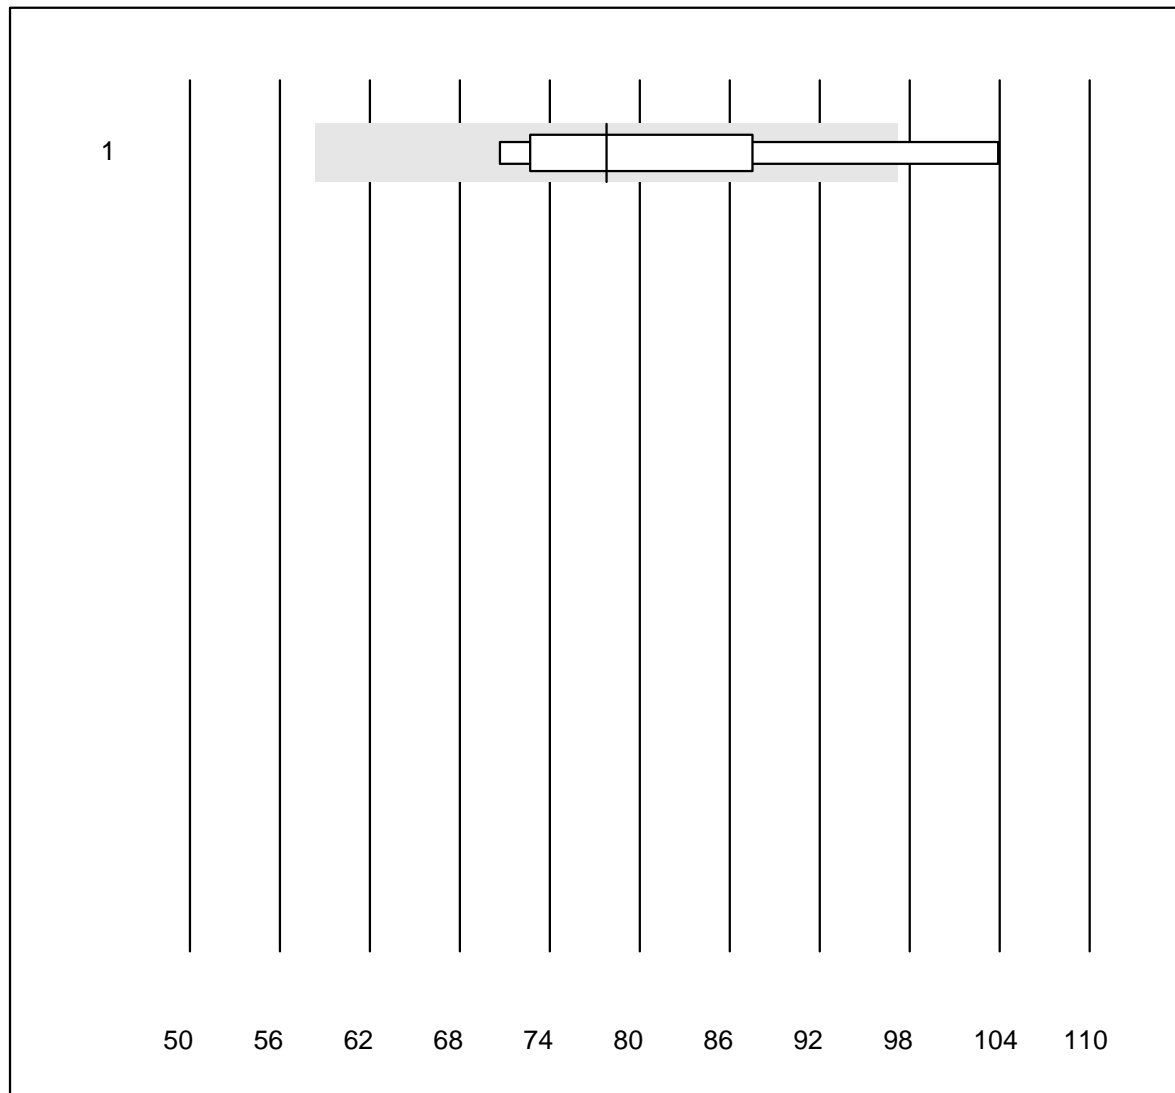


Tolérance MQ : 25 %

Inhibin B (ng/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	5	80.0	20.0	0.0	78	16.5	e*

# Calcitonin

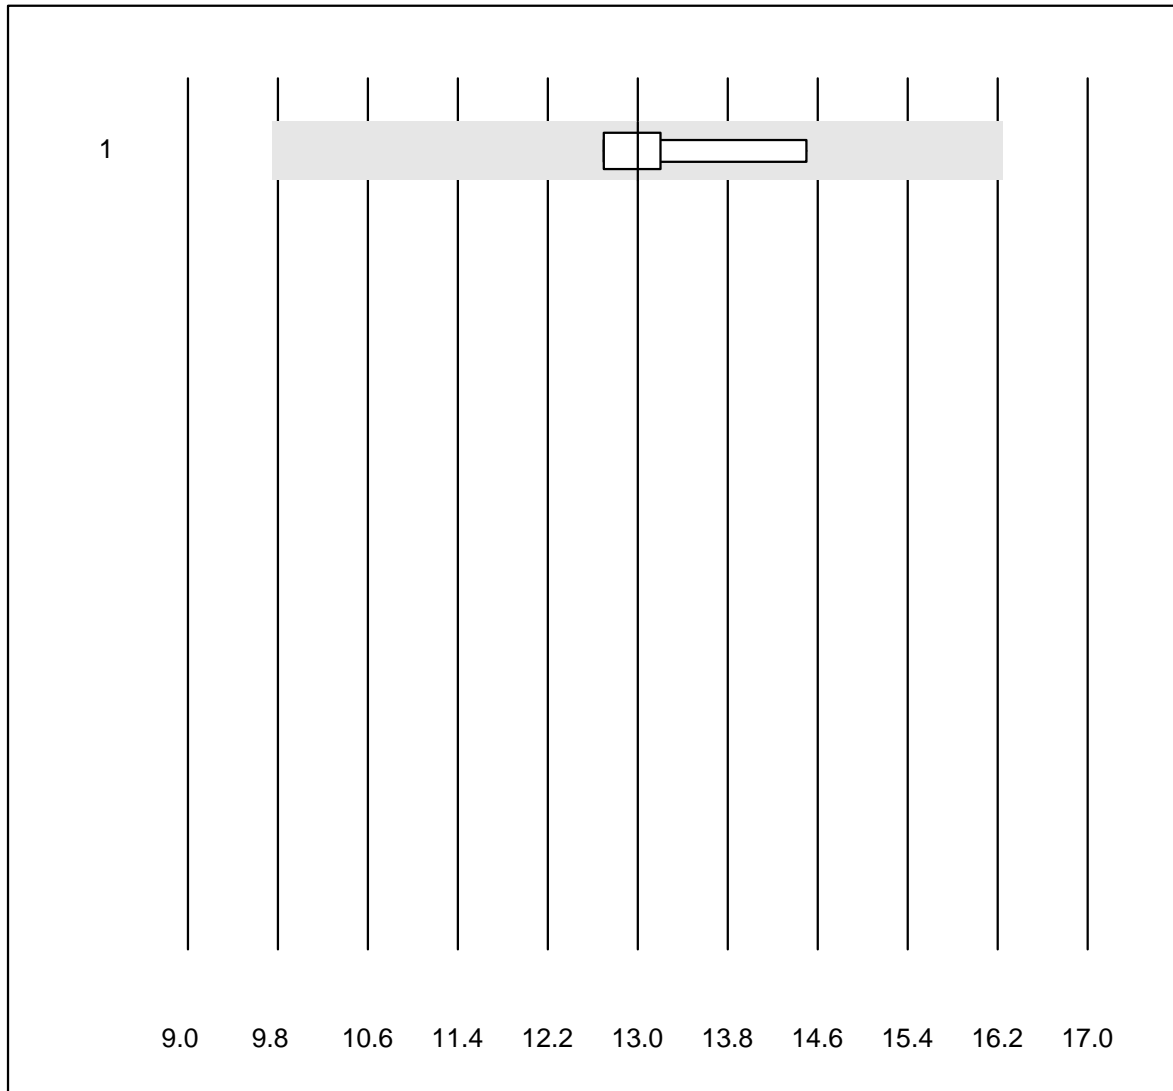


Tolérance MQ : 25 %

Calcitonin (pmol/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	13.0	6.2	e*

## Anti Thyreoglobulin

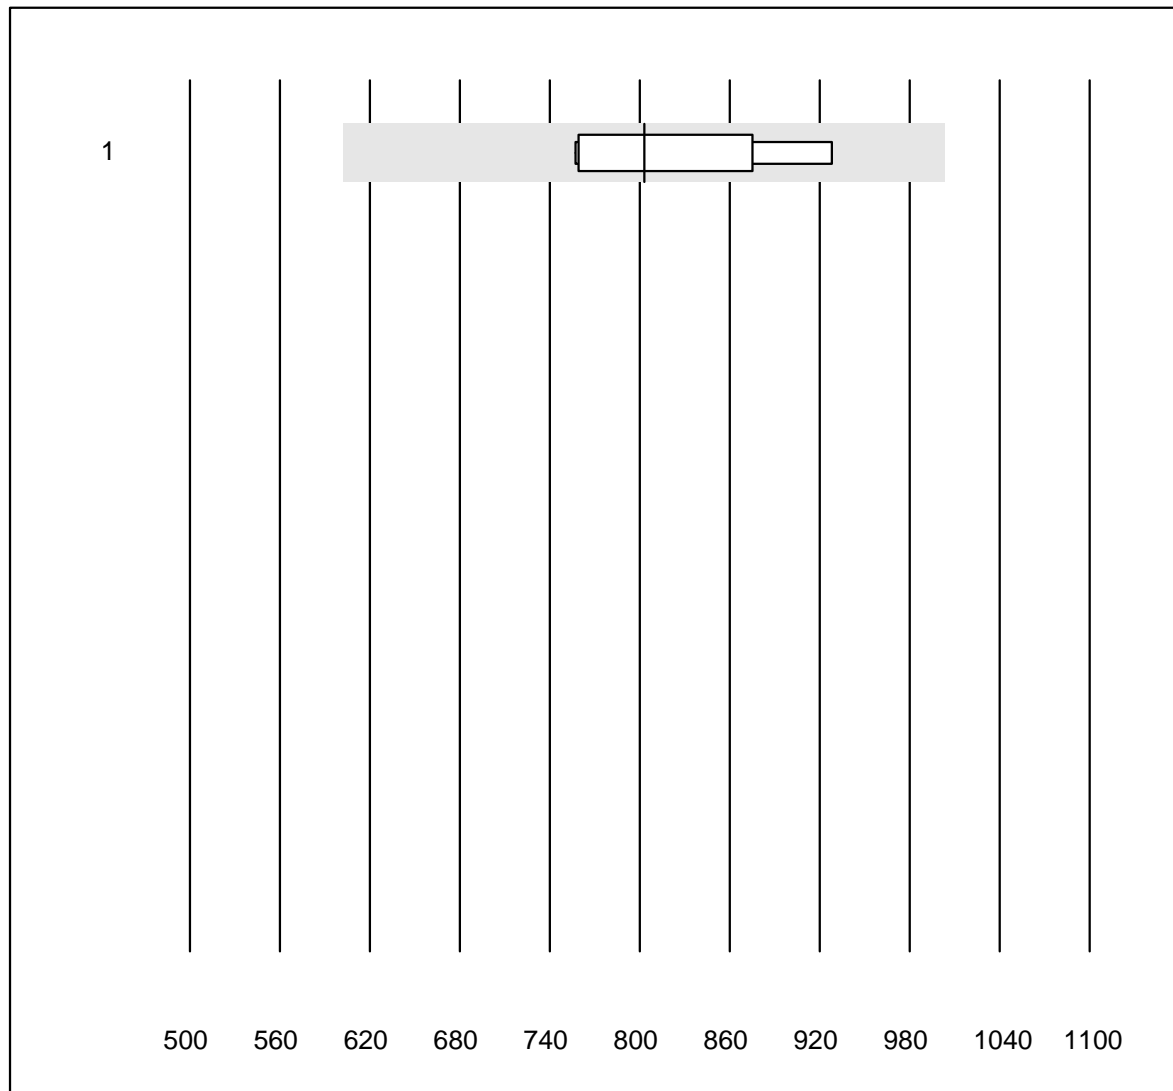


Tolérance MQ : 25 %

Anti Thyreoglobulin (IU/ml)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	8	100.0	0.0	0.0	803	7.9	e

## Anti TPO

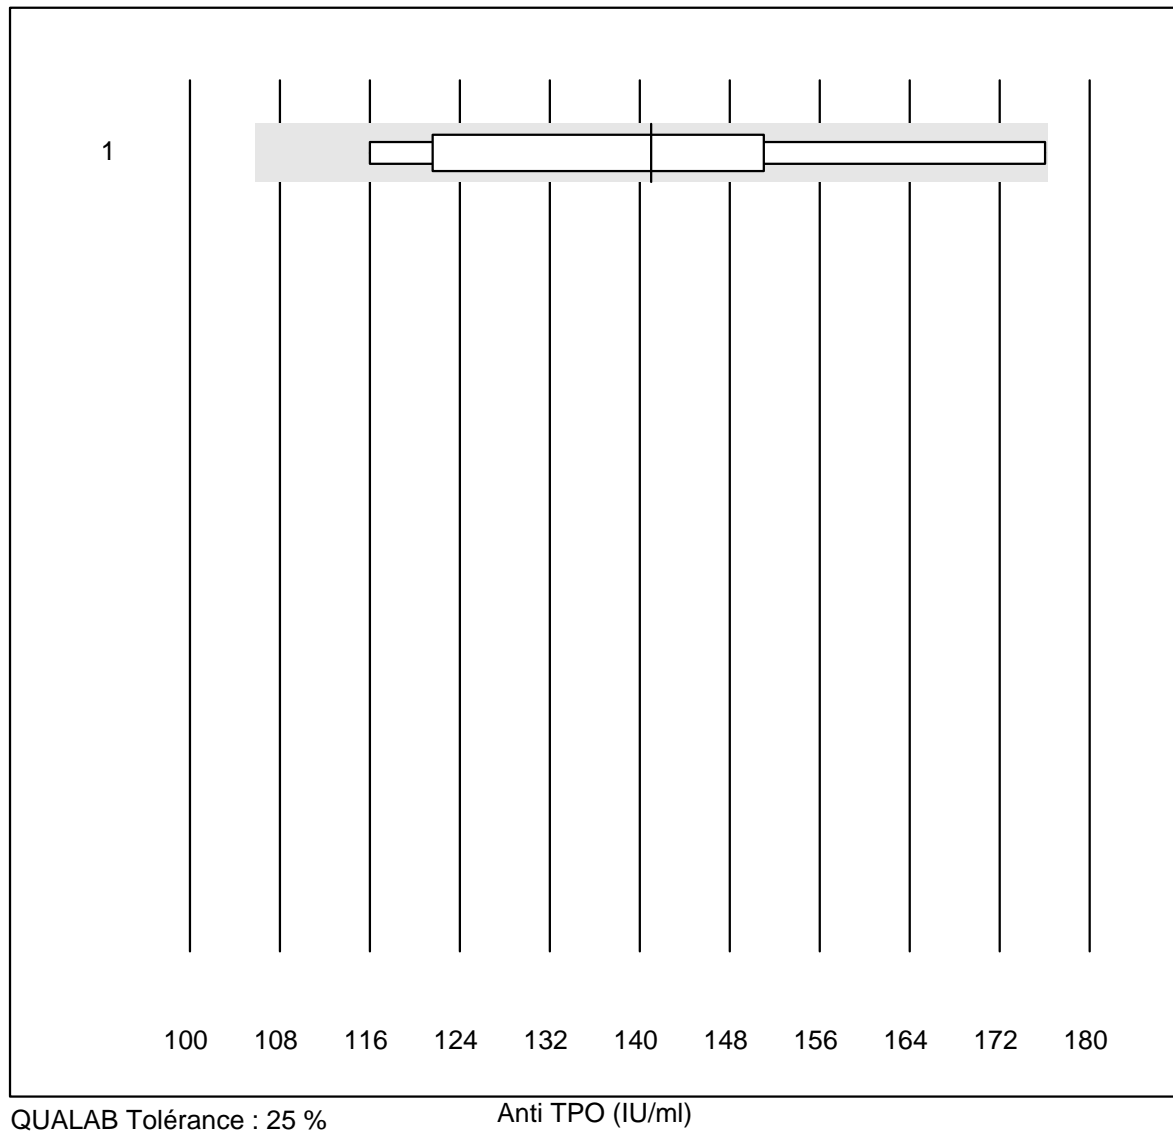

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	8	100.0	0.0	0.0	141	14.9	e*

# TRAK

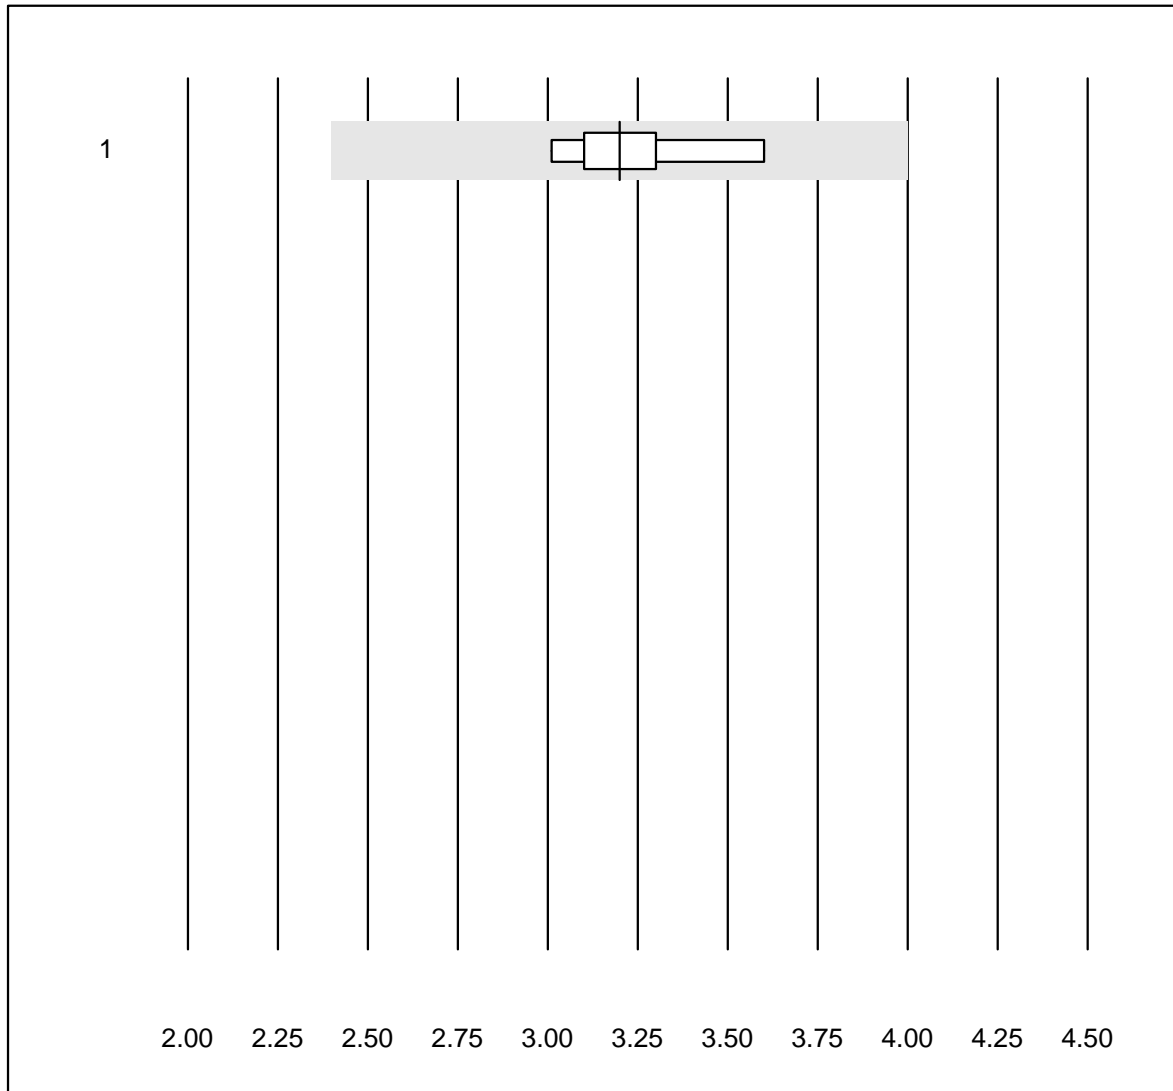


Tolérance MQ : 25 %

TRAK (IU/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	3.20	7.0	e*



## Créatinine WB

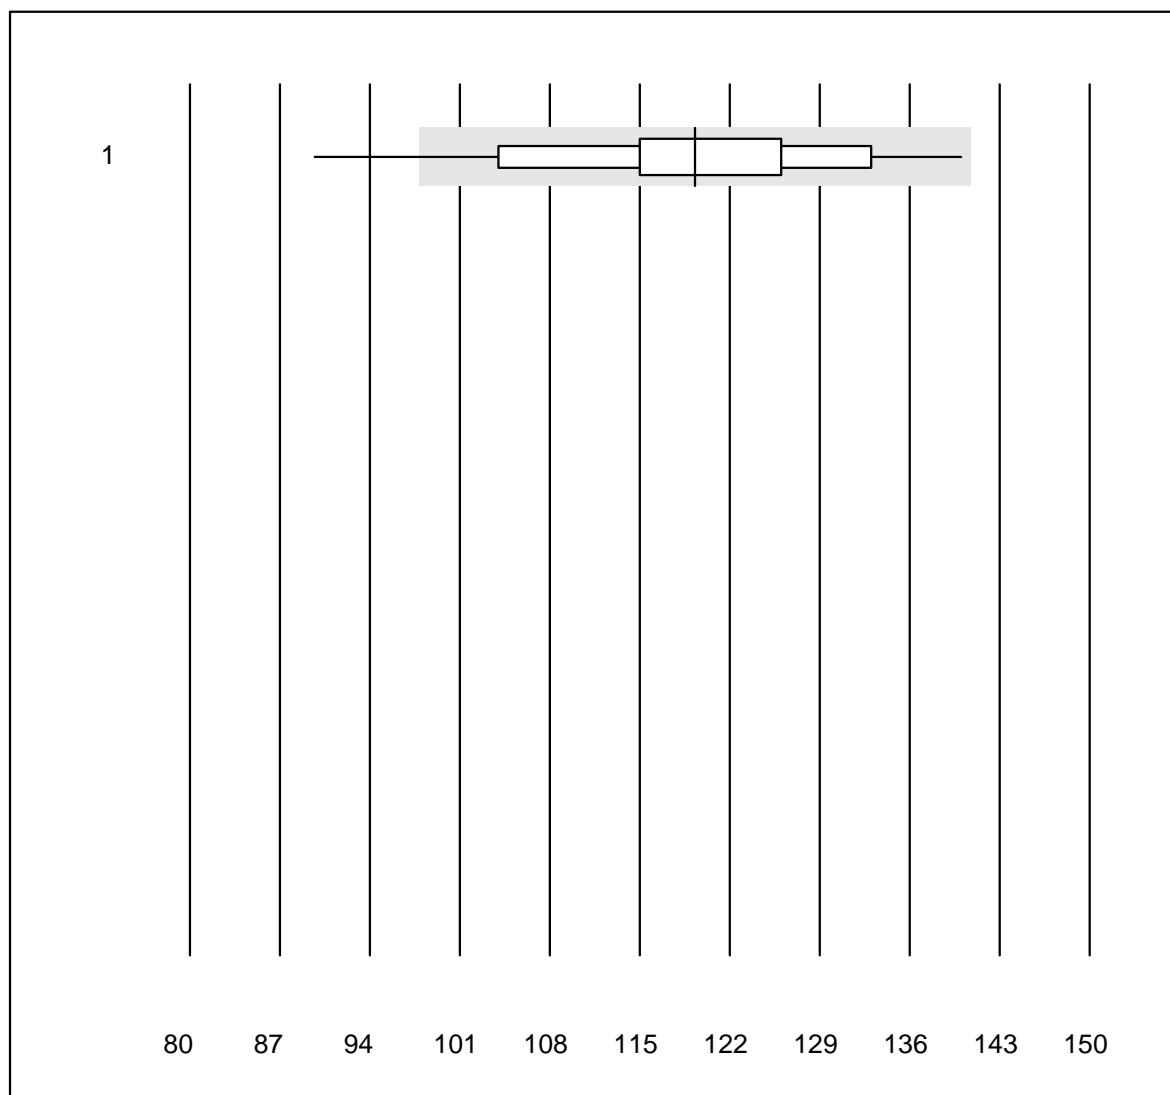


QUALAB Tolérance : 18 %

Créatinine WB (µmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Statsensor i / Nova	49	87.7	4.1	8.2	119	9.1	e

# IL6

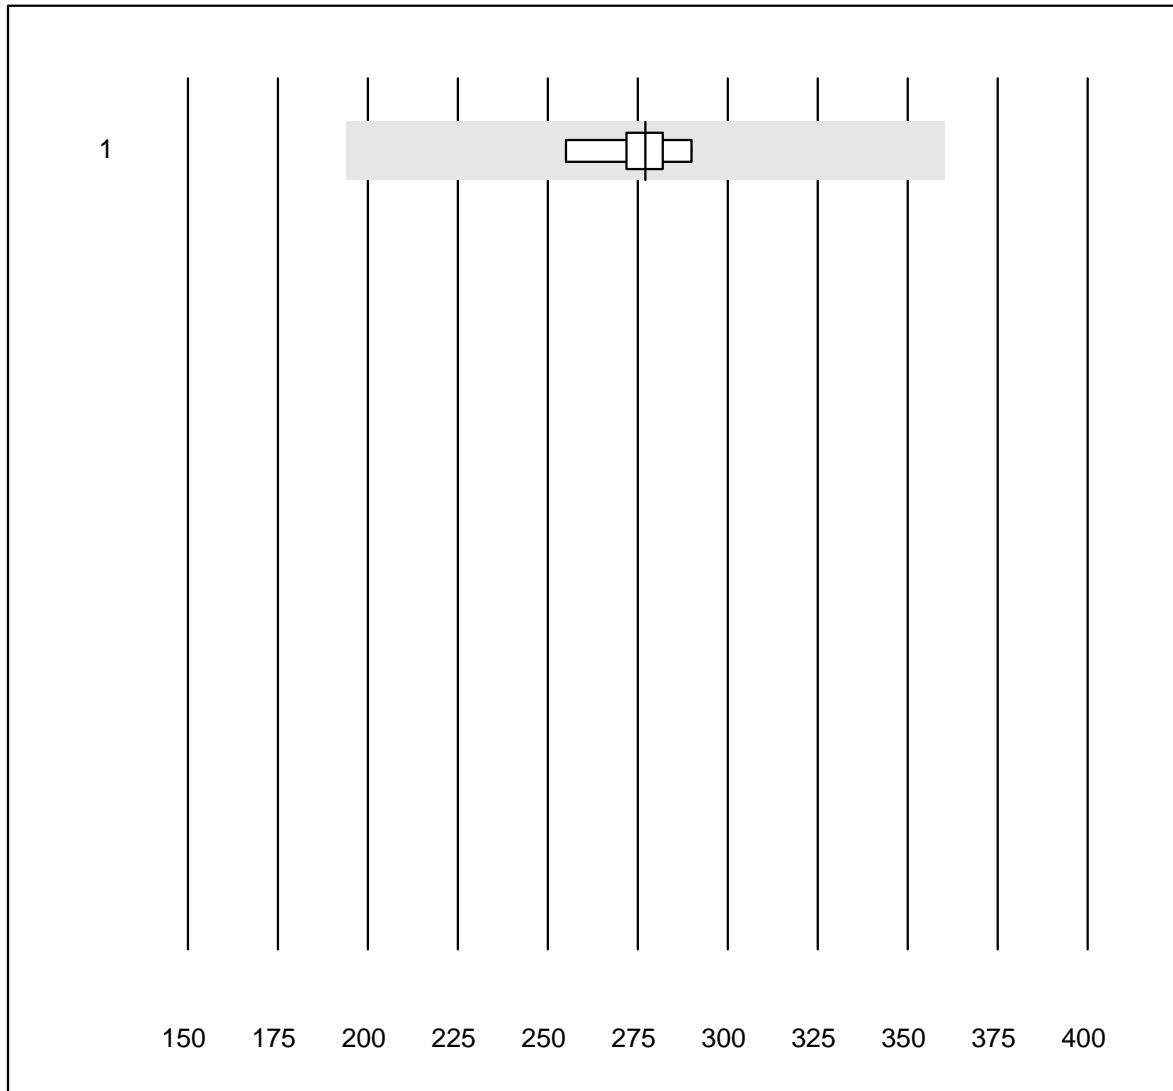


Tolérance MQ : 30 %

IL6 (ng/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	277.0	4.8	e

## D-Dimere qn

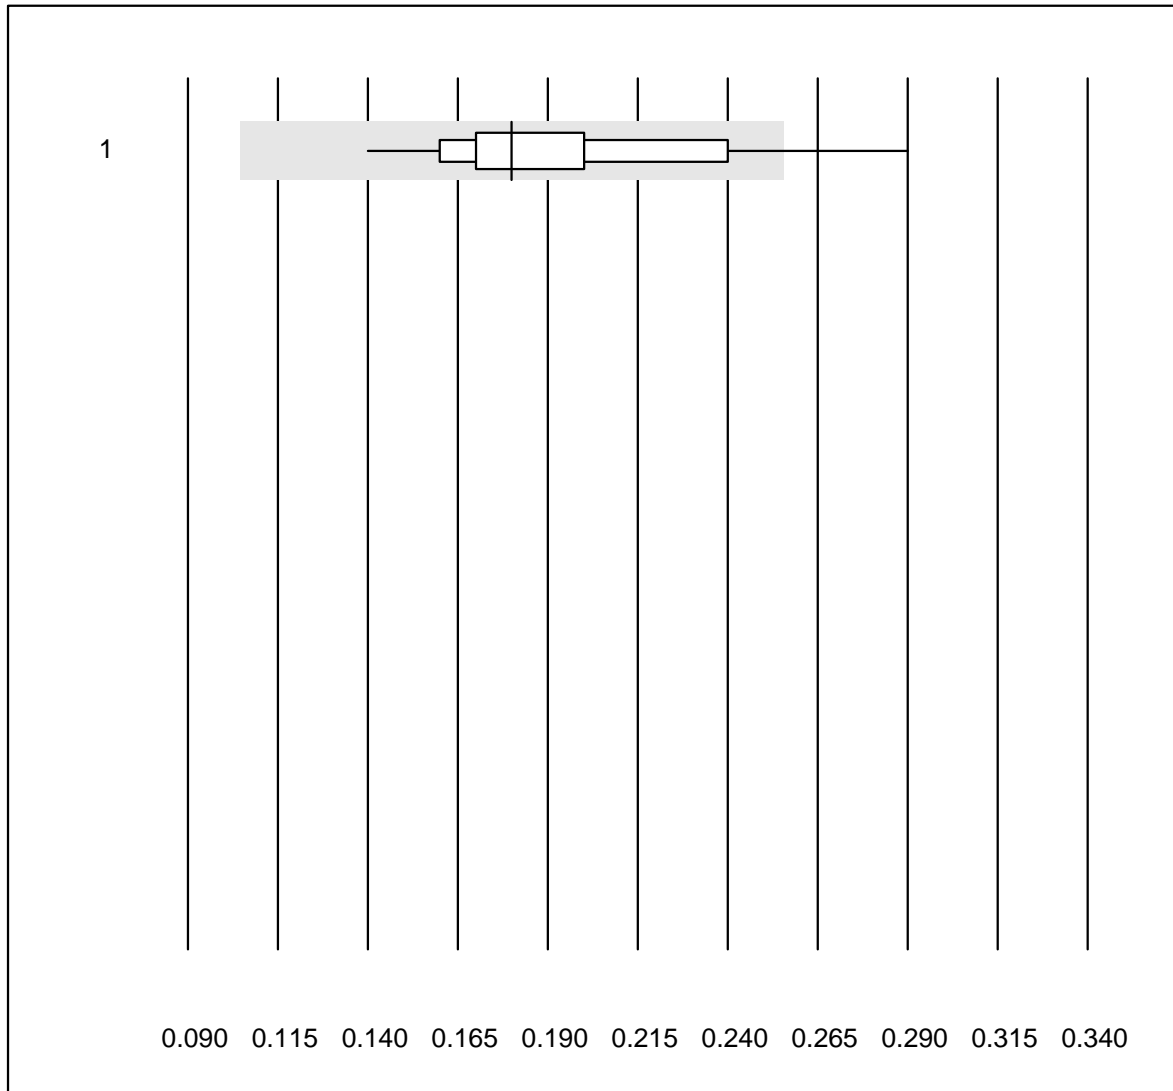


QUALAB Tolérance : 0 %

D-Dimere qn (mg/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Exdia TRF	47	91.5	6.4	2.1	0.18	17.6	a

## Troponin I qn

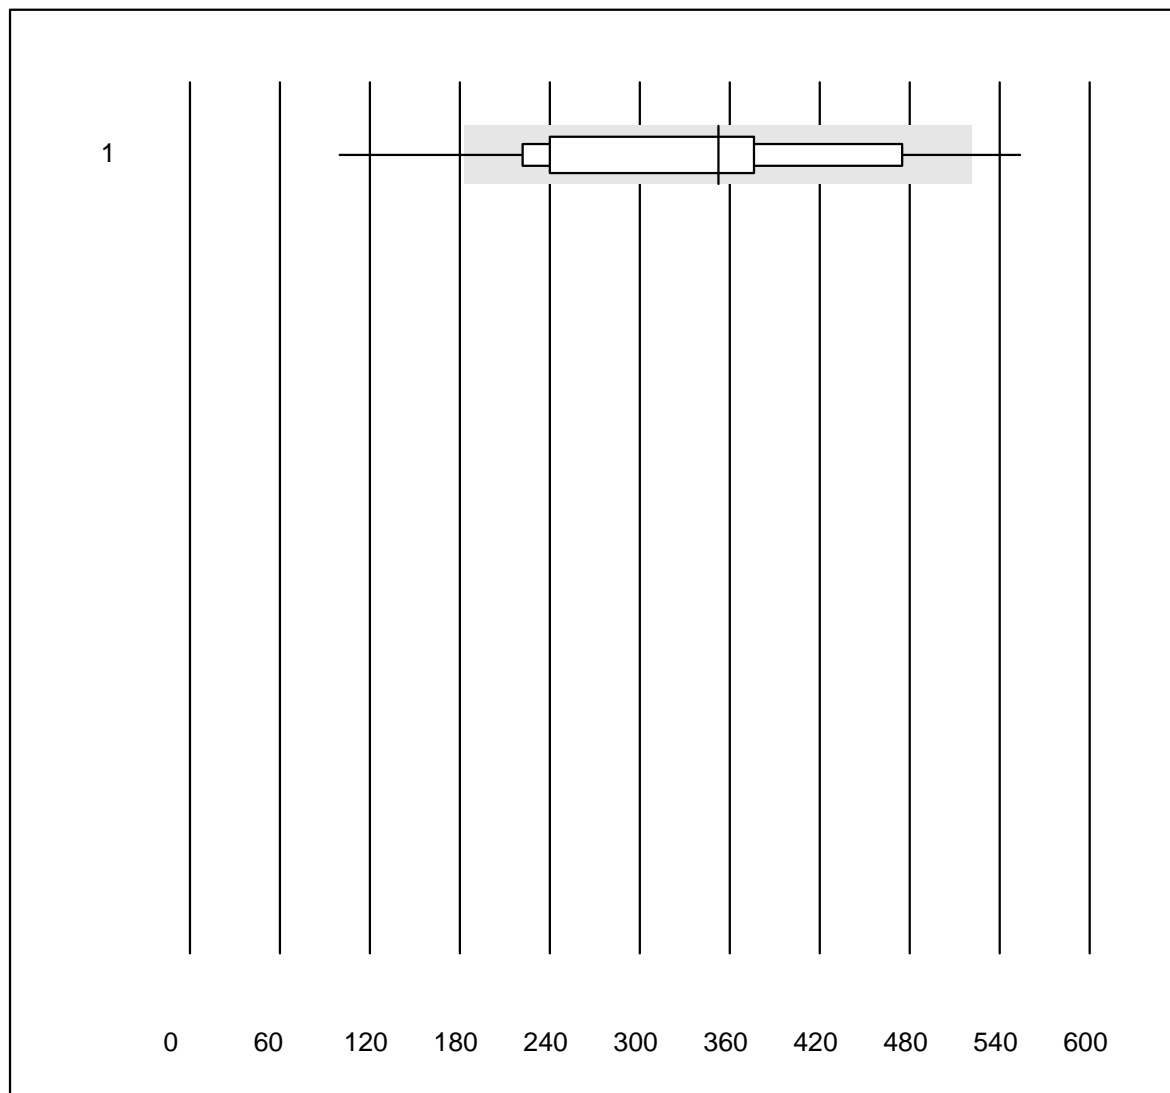


QUALAB Tolérance : 0 %

Troponin I qn (ng/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Exdia TRF	47	80.9	10.6	8.5	352.33	34.4	a


# proBNP

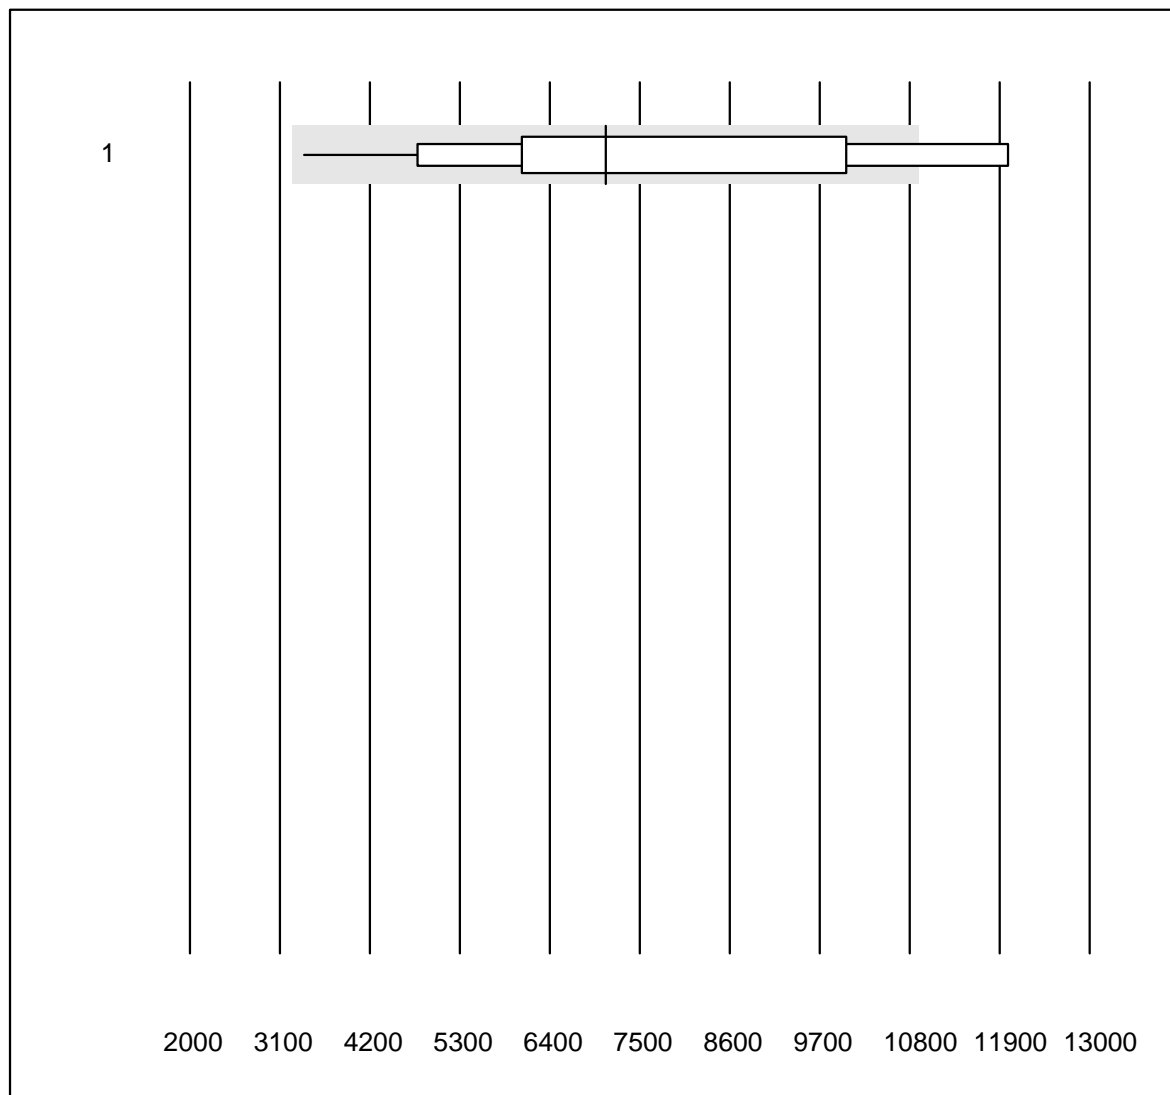

QUALAB Tolérance : 0 % proBNP (ng/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Exdia TRF	42	73.9	19.0	7.1	7085.4	32.3	a

## Calcium-urine

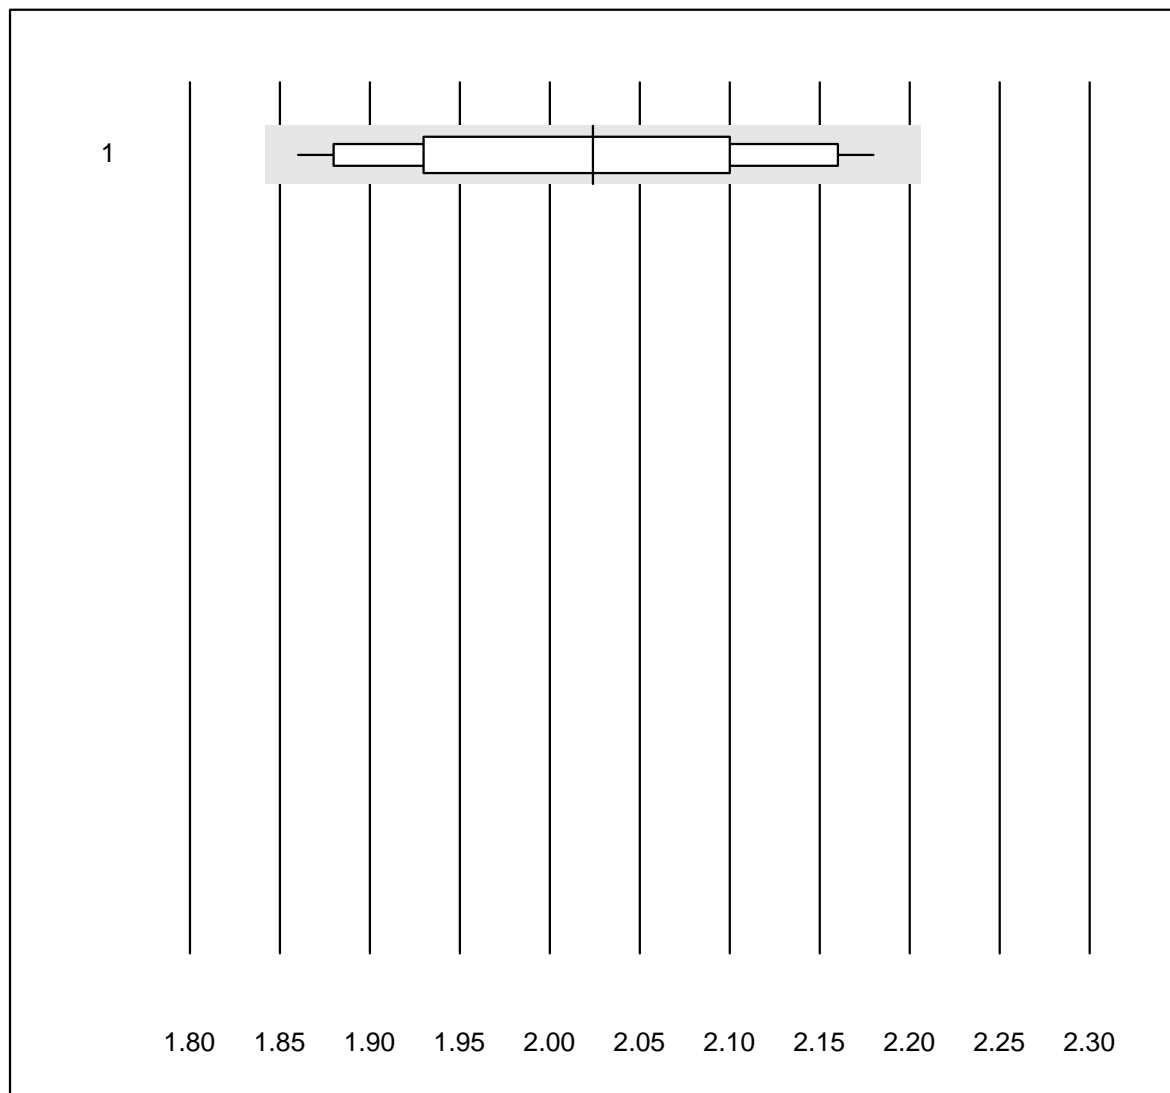


Tolérance MQ : 9 %

Calcium-urine (mmol/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	19	100.0	0.0	0.0	2.02	4.8	e*

## Chlorures-urine

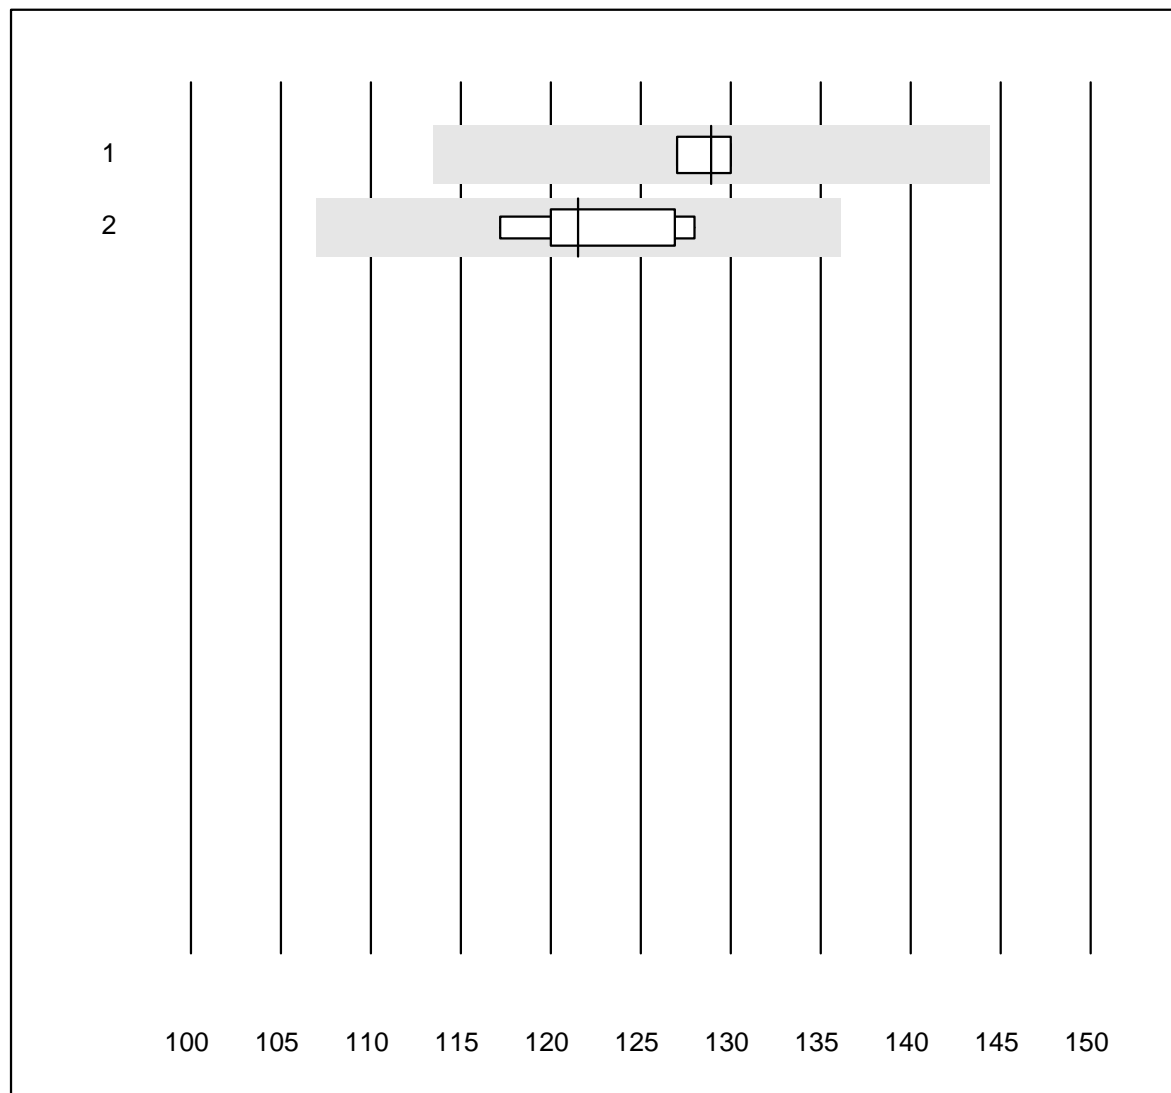


Tolérance MQ : 12 %

Chlorures-urine (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	7	100.0	0.0	0.0	129	1.1	e
2 Cobas	7	100.0	0.0	0.0	122	3.1	e

## Glucose-urine

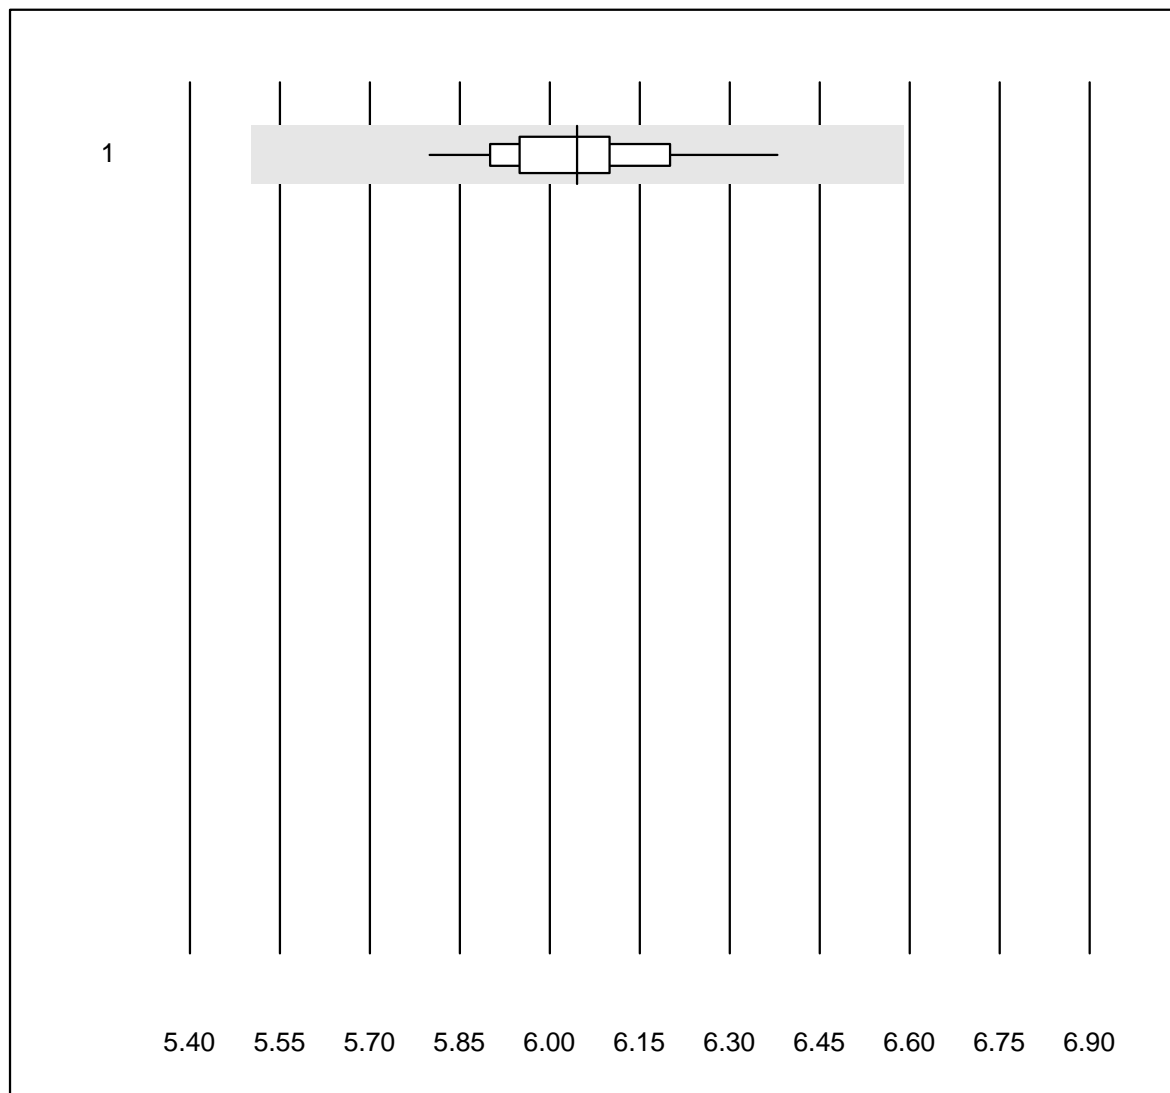


QUALAB Tolérance : 9 %

Glucose-urine (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	16	100.0	0.0	0.0	6.0	2.3	e



## Magnésium-urine

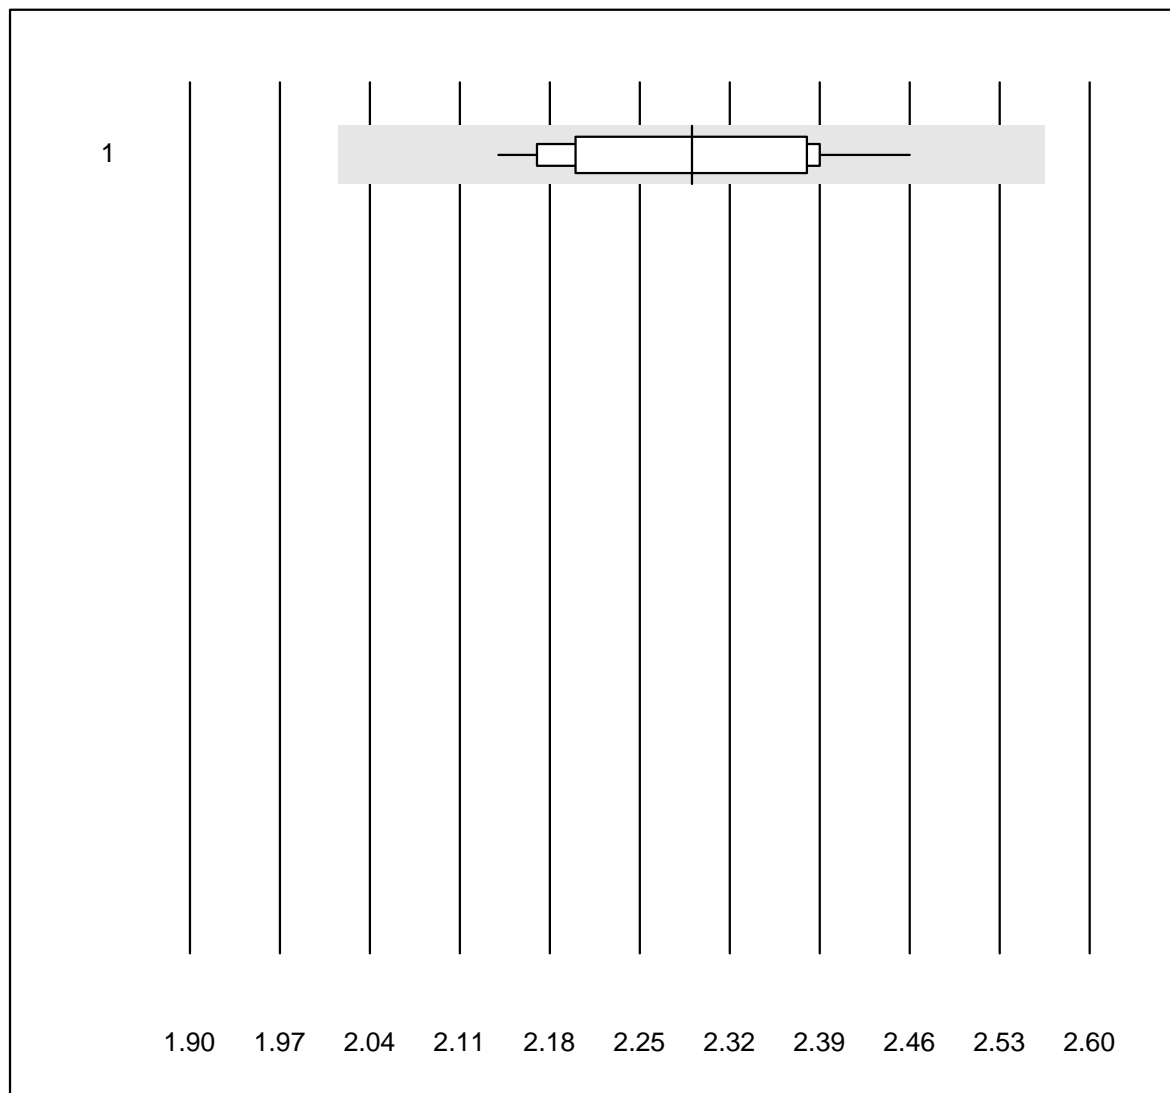


Tolérance MQ : 12 %

Magnésium-urine (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	11	100.0	0.0	0.0	2.29	4.3	e

## Osmolalité-urine

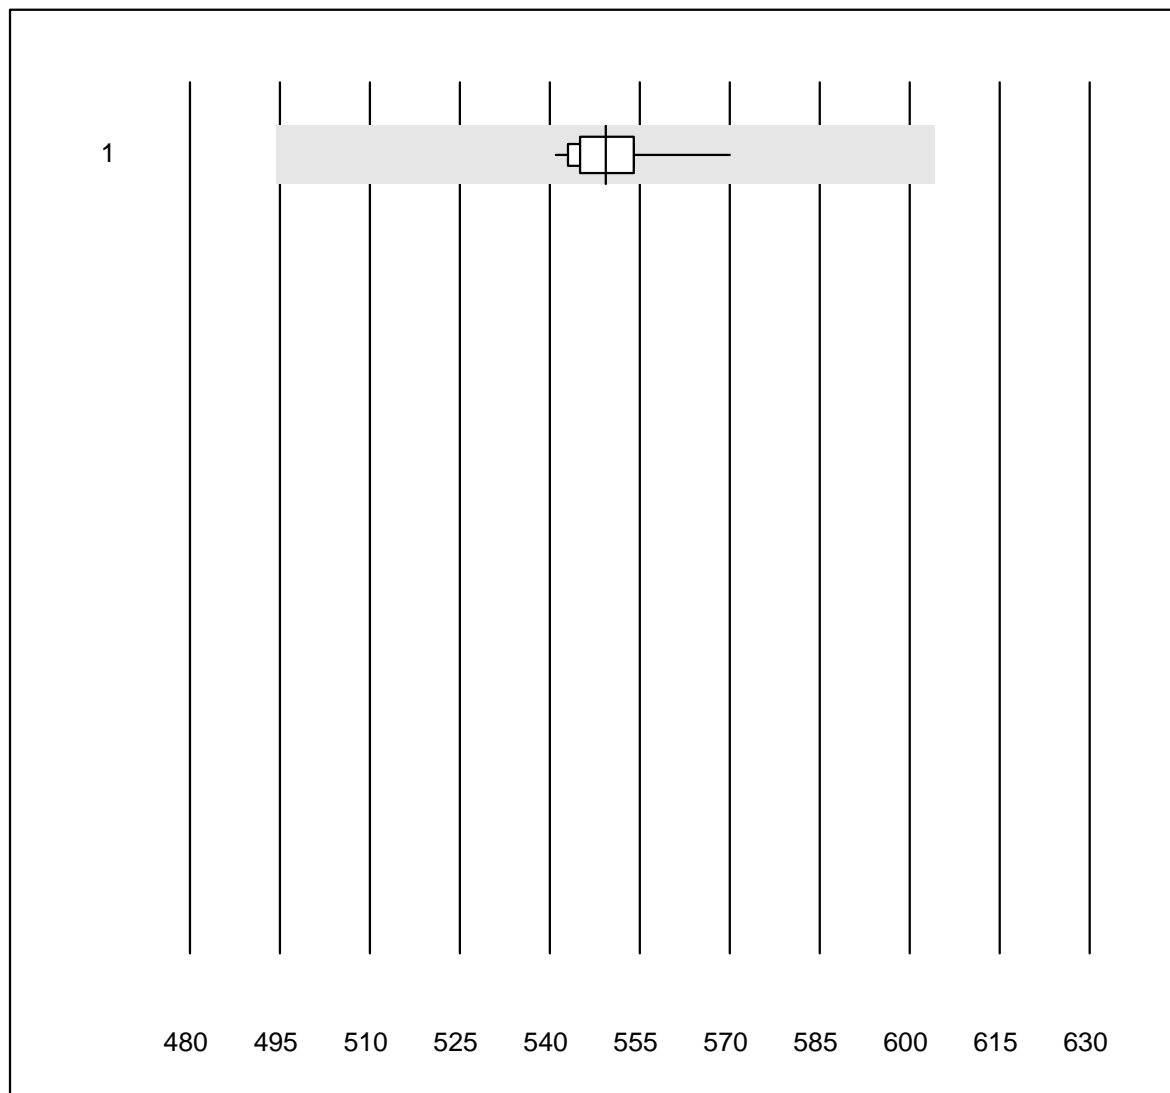


Tolérance MQ : 10 %

Osmolalité-urine (mosm/kg)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cryoscopie	15	100.0	0.0	0.0	549	1.3	e

## Phosphore-urine

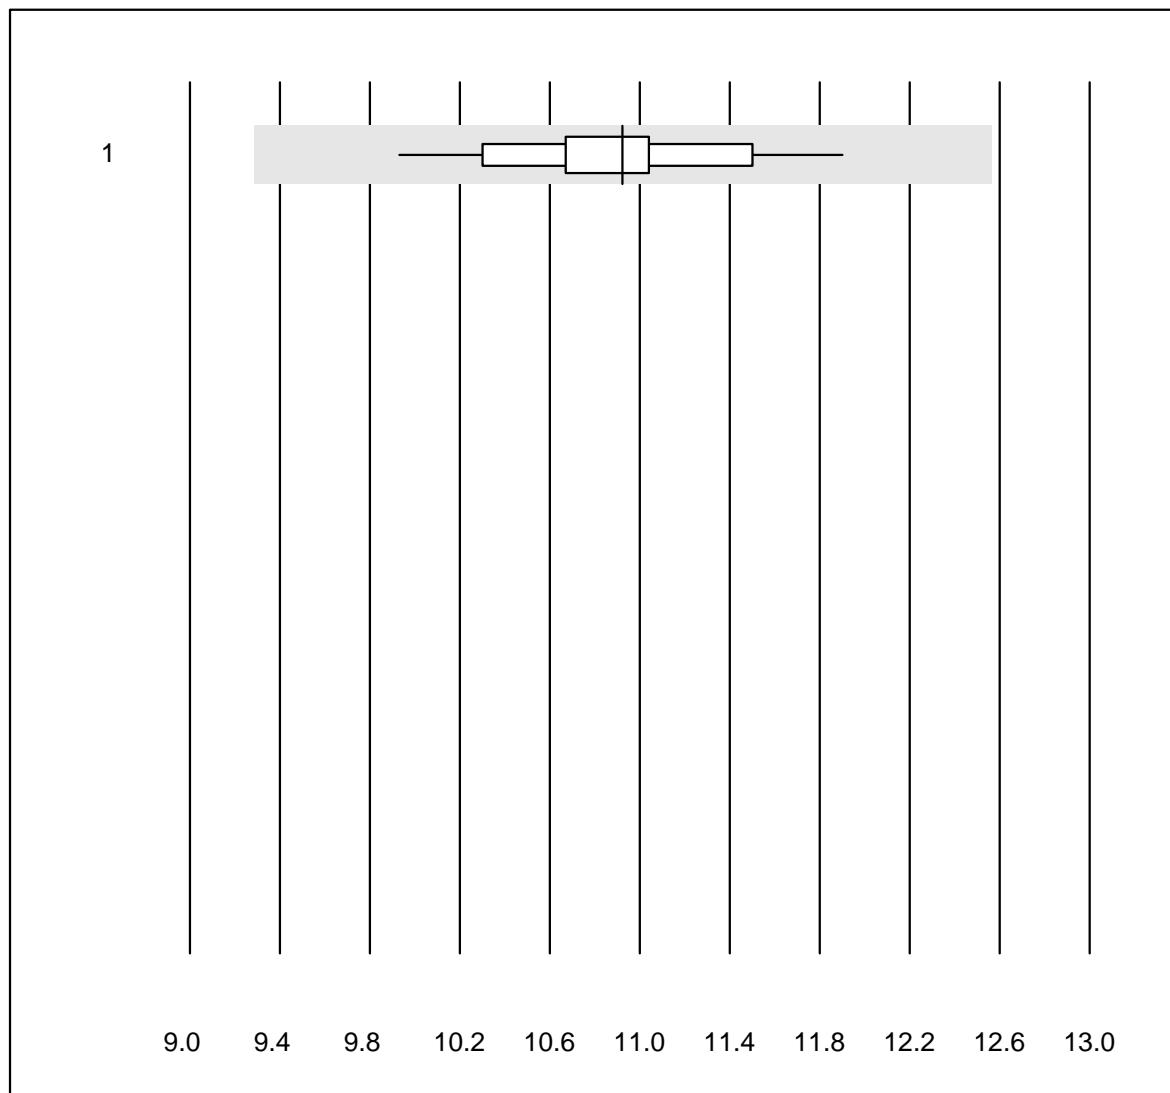


Tolérance MQ : 15 %

Phosphore-urine (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	16	100.0	0.0	0.0	10.9	4.1	e

## Potassium-urine

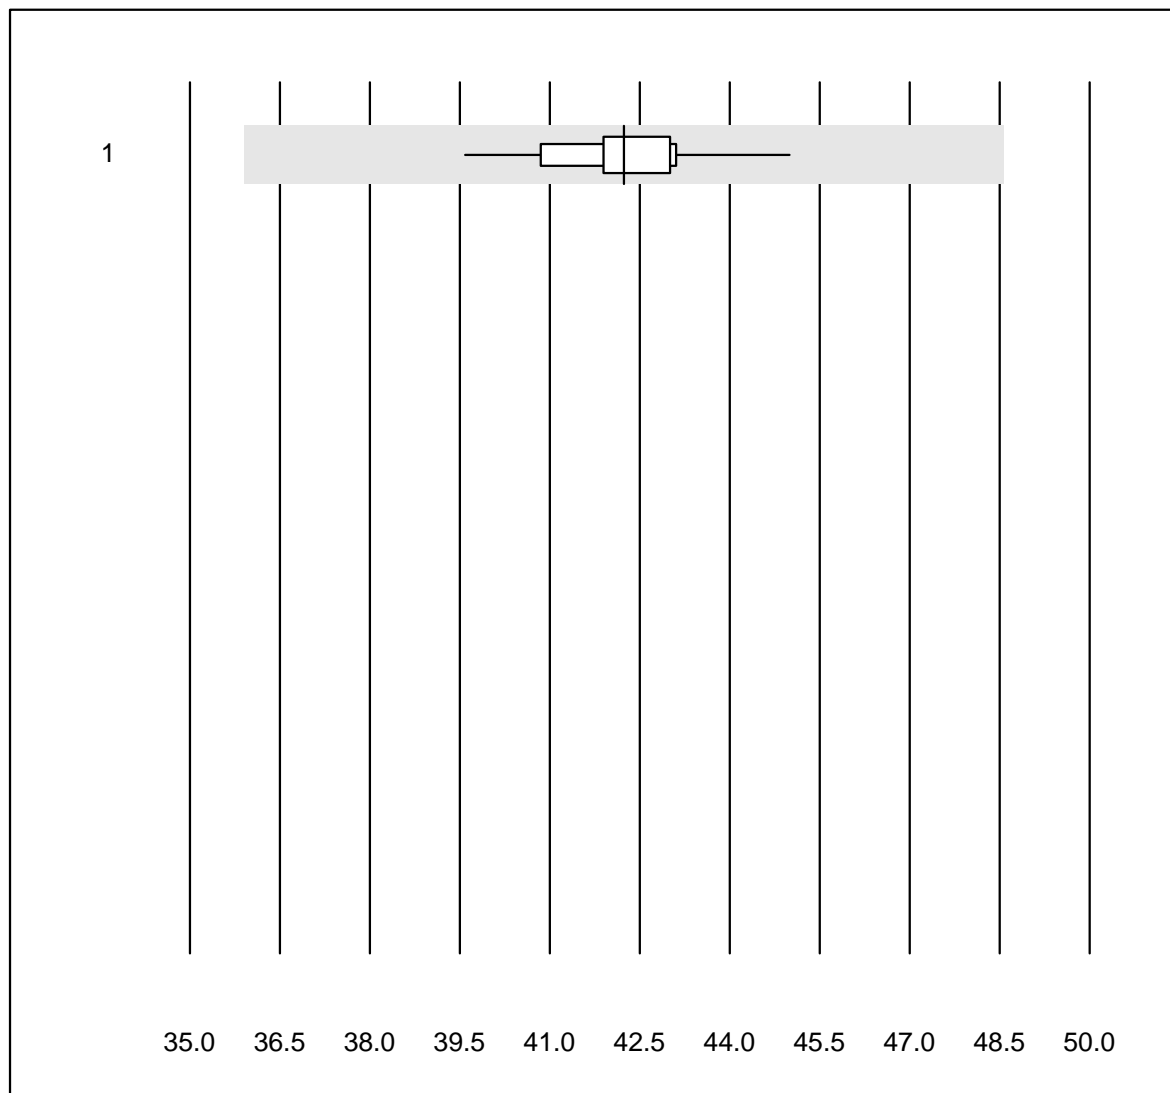


Tolérance MQ : 15 %

Potassium-urine (mmol/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	24	100.0	0.0	0.0	42	2.7	e

## Protéines-urine

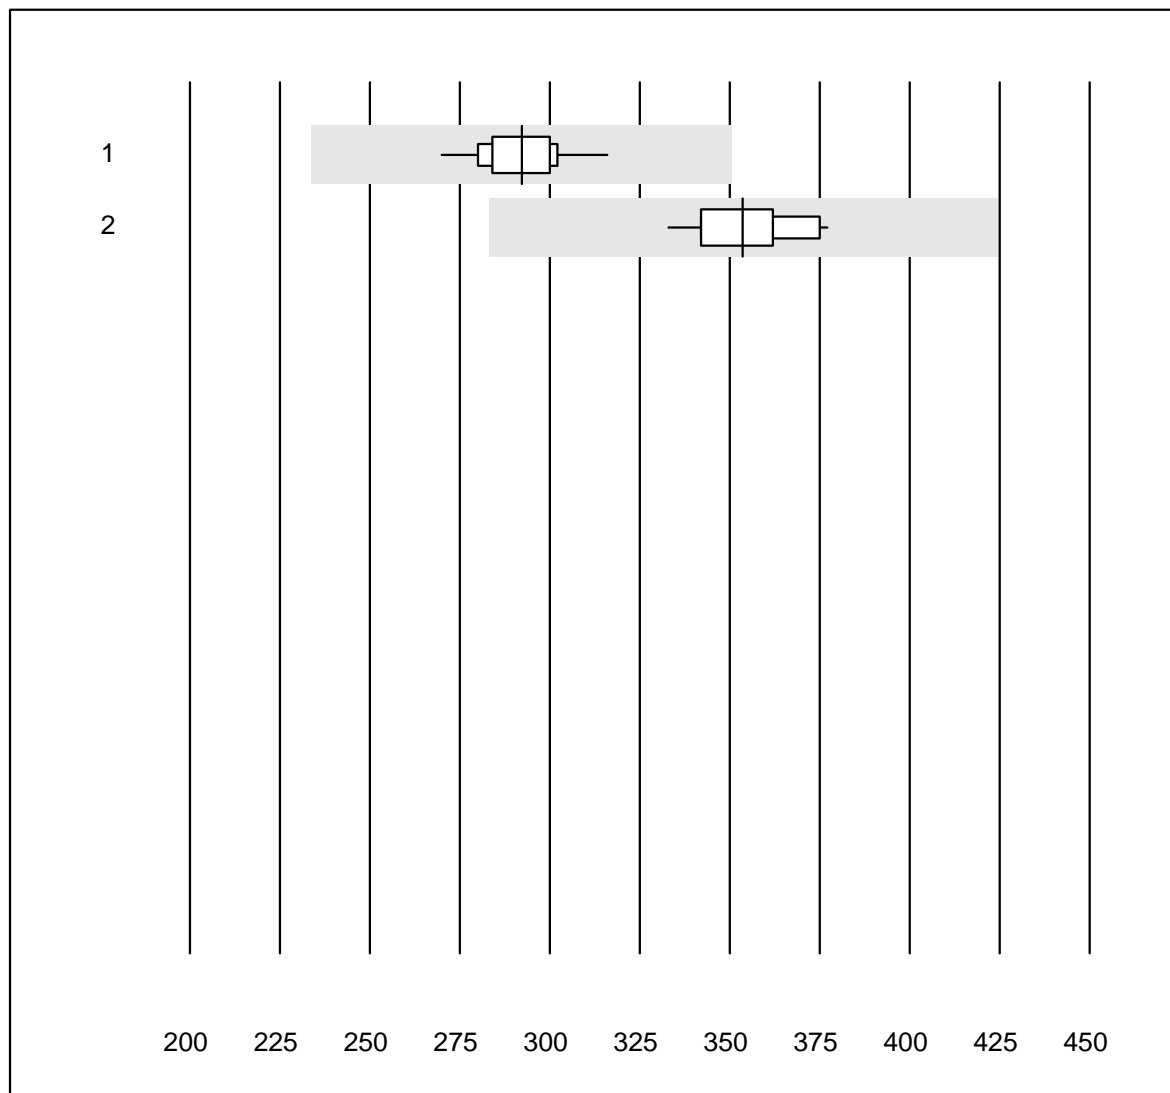


QUALAB Tolérance : 20 %

Protéines-urine (mg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas/Roche	13	100.0	0.0	0.0	292.2	4.1	e
2 Chimie humide	12	100.0	0.0	0.0	353.7	4.0	e

## Sodium-urine

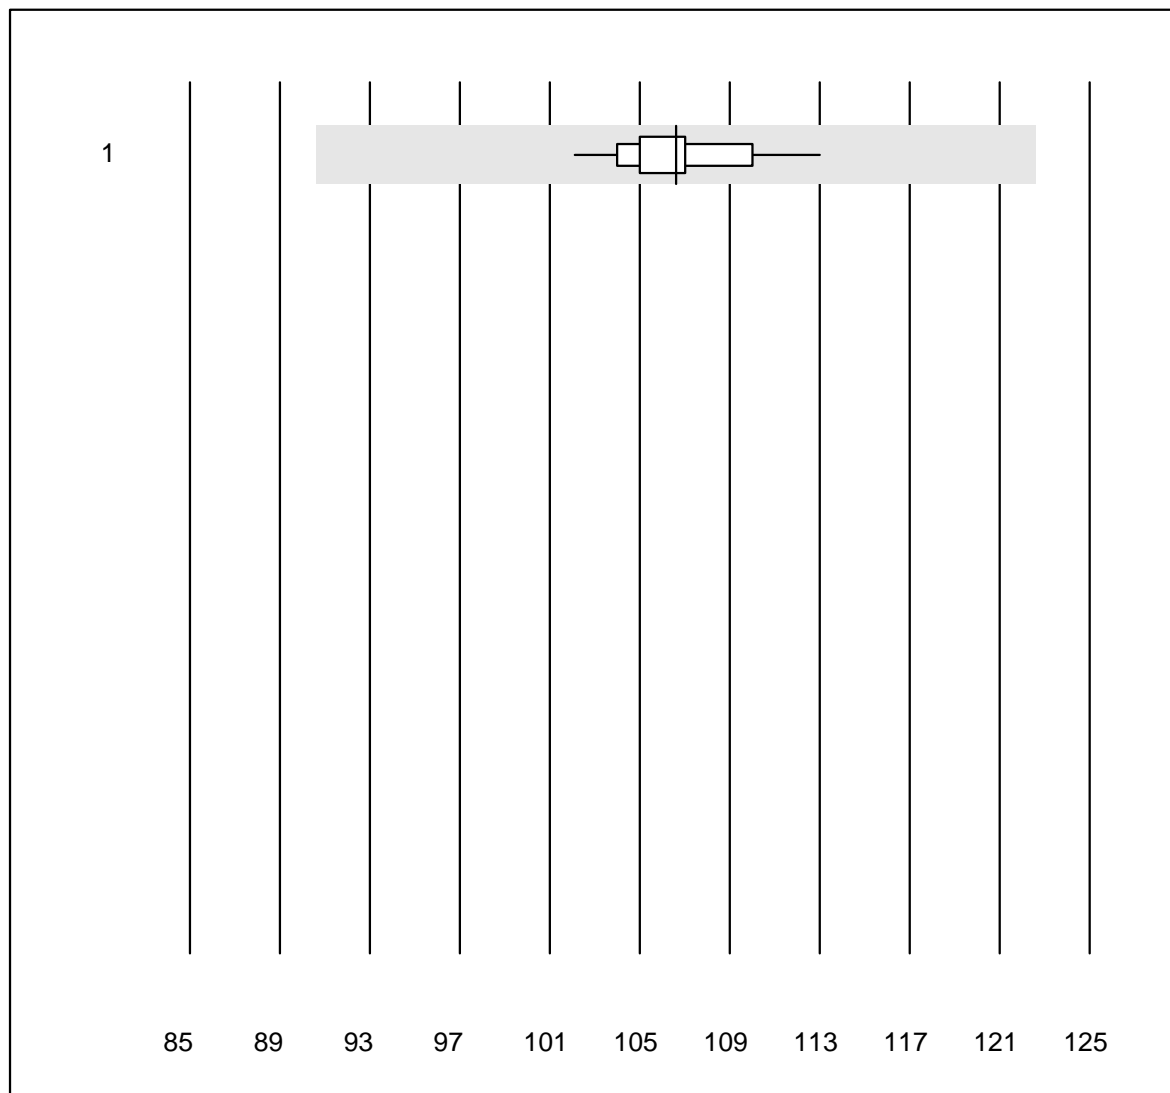


Tolérance MQ : 15 %

Sodium-urine (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	24	100.0	0.0	0.0	107	2.2	e

## Urée-urine

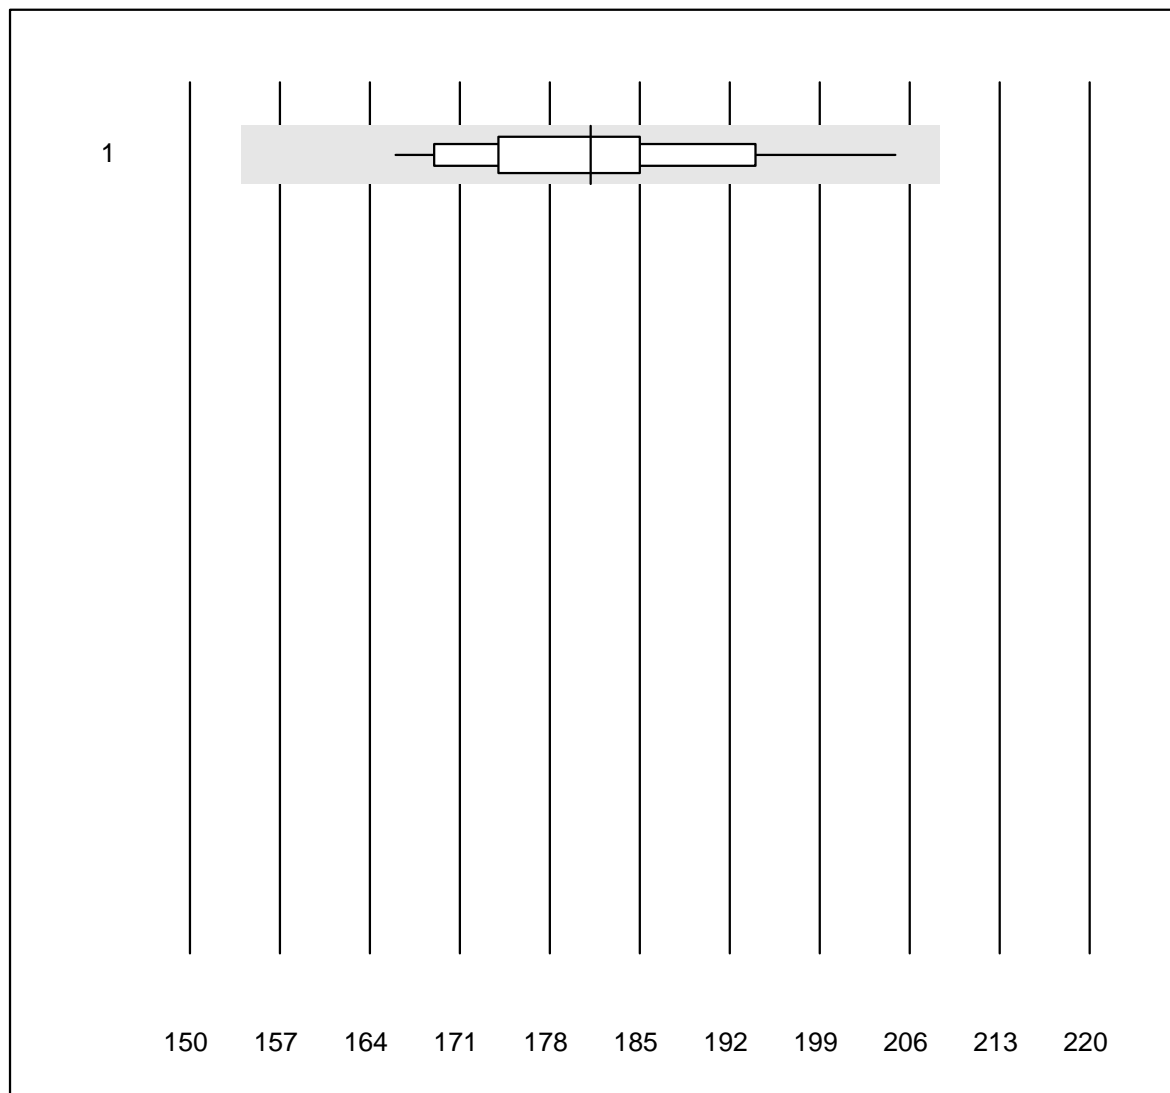


Tolérance MQ : 15 %

Urée-urine (mmol/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	21	100.0	0.0	0.0	181	5.6	e

## Acide urique-urine

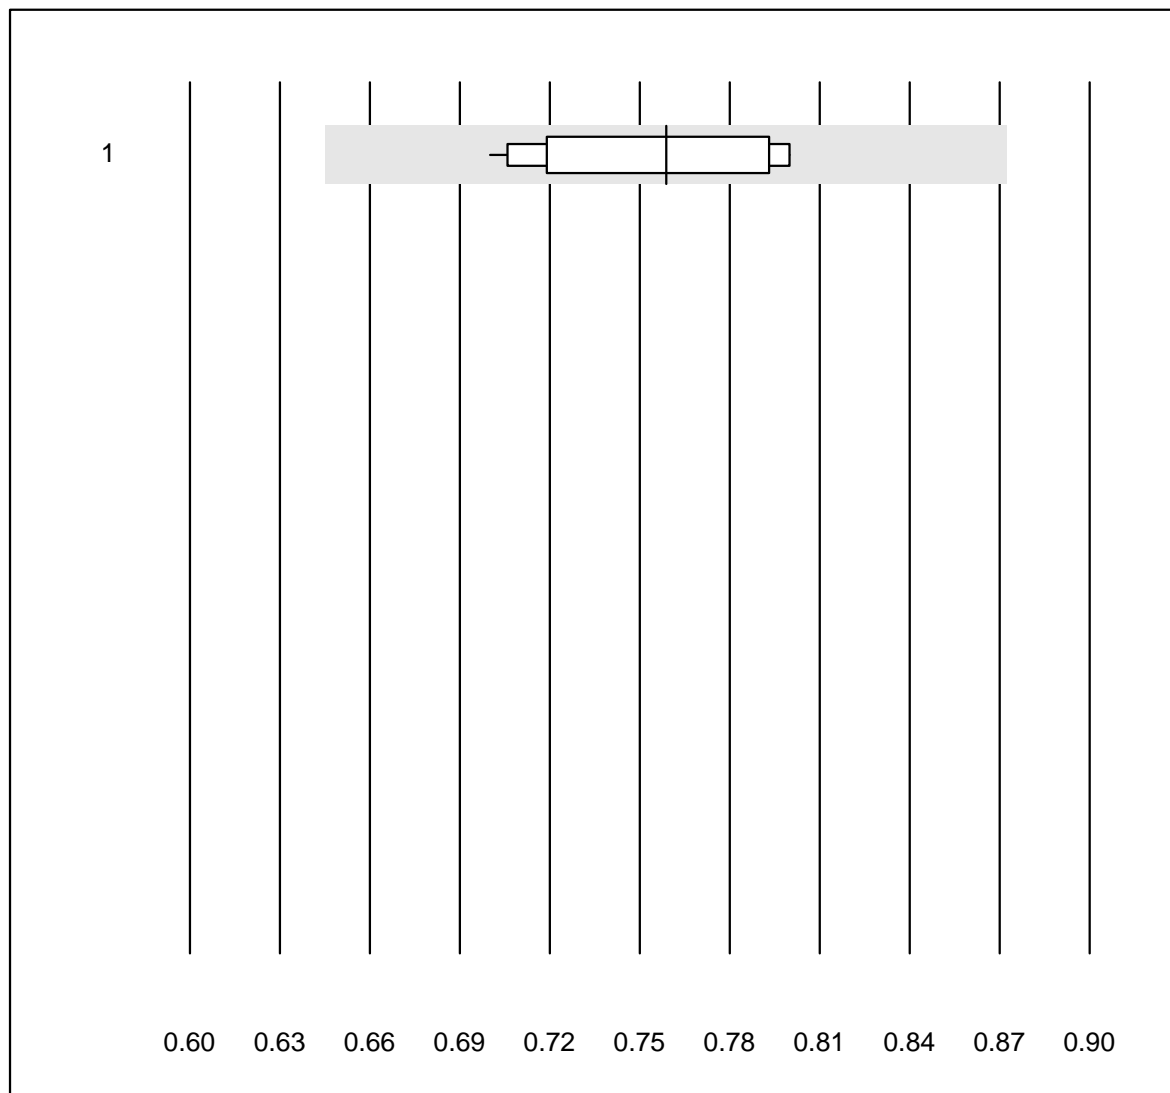


Tolérance MQ : 15 %

Acide urique-urine (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	15	100.0	0.0	0.0	0.76	4.8	e



## Gravité spécifique-urine

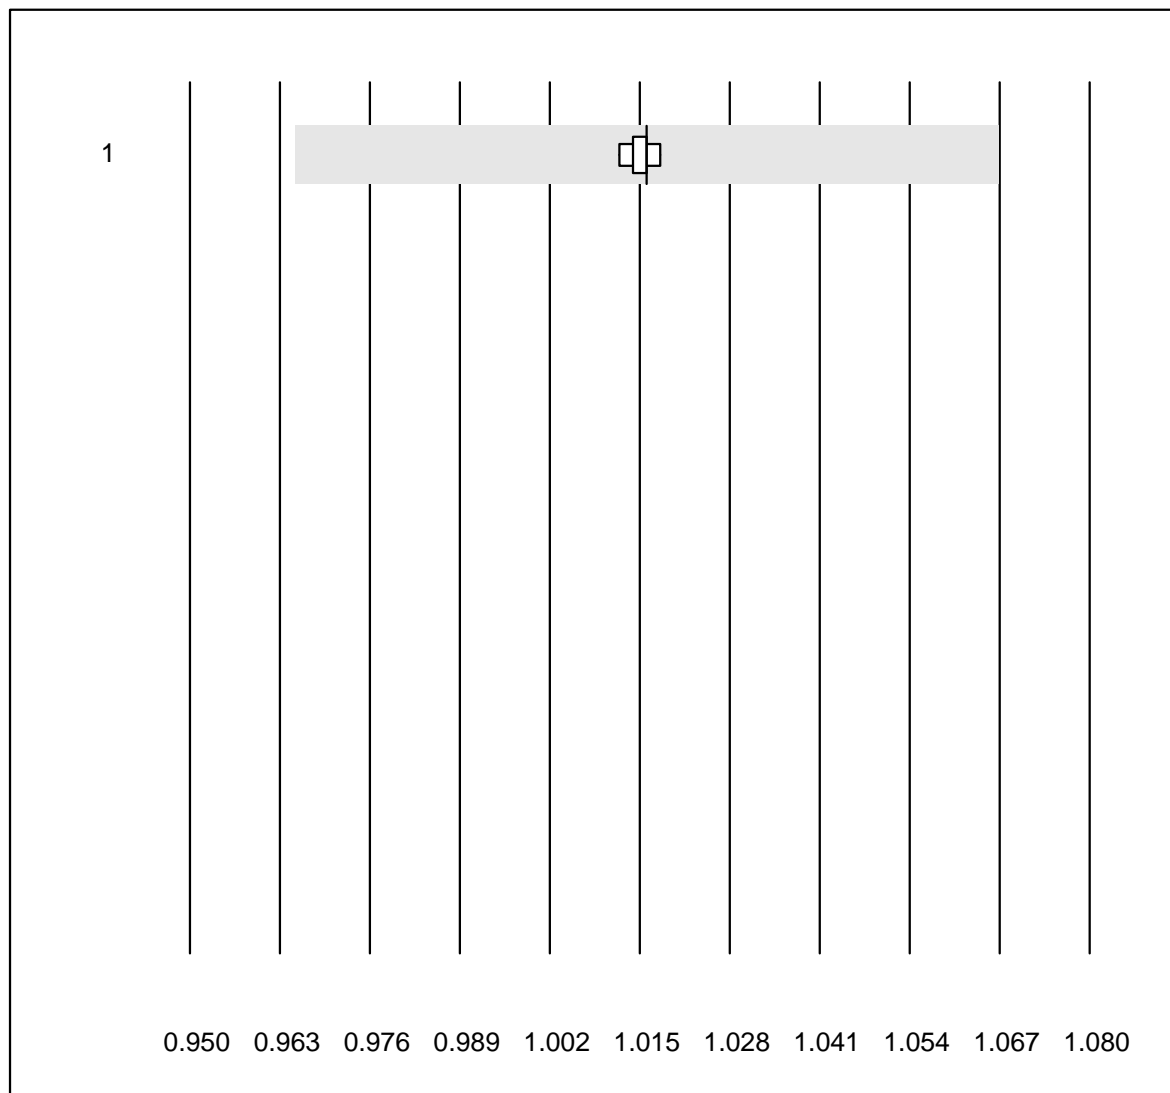


Tolérance MQ : 5 %

Gravité spécifique-urine ()

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Refraktometer	5	100.0	0.0	0.0	1.016	0.2	e

## Microalbumine

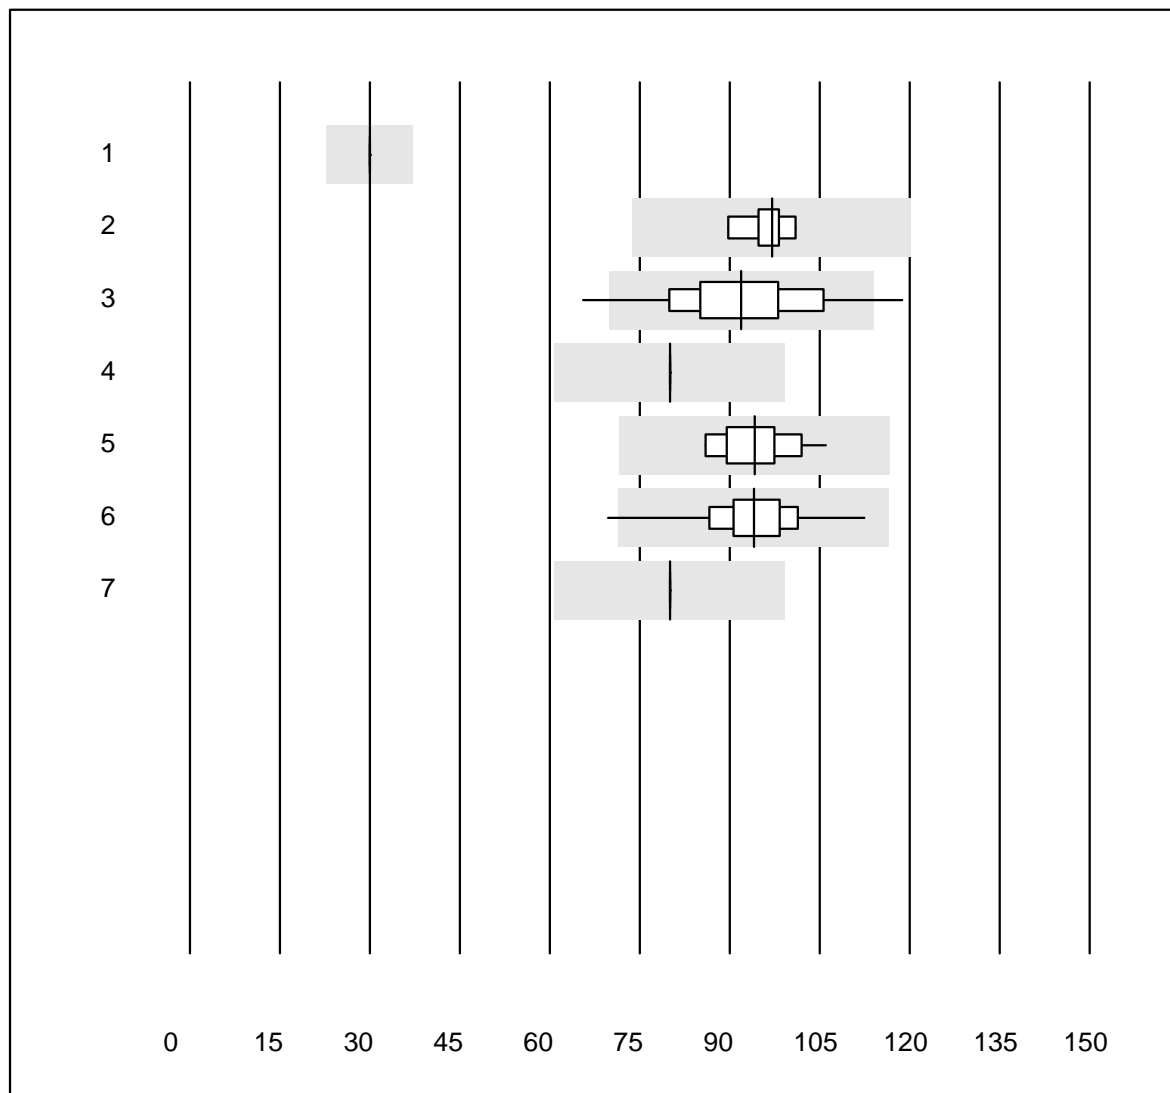


QUALAB Tolérance : 24 %

Microalbumine (mg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Aution	4	100.0	0.0	0.0	30.0	0.0	a
2 AFIAS	10	90.0	0.0	10.0	97.0	3.3	e
3 Afinion	439	93.4	2.5	4.1	91.9	10.4	e
4 Sysmex U	18	55.6	0.0	44.4	80.0	0.0	e
5 Turbidimetrie	29	100.0	0.0	0.0	94.2	6.2	e
6 DCA2000/Vantage	147	97.9	0.7	1.4	94.0	6.6	e
7 Siemens Clinitek	16	87.5	0.0	12.5	80.0	0.0	a

## Créatinine urine

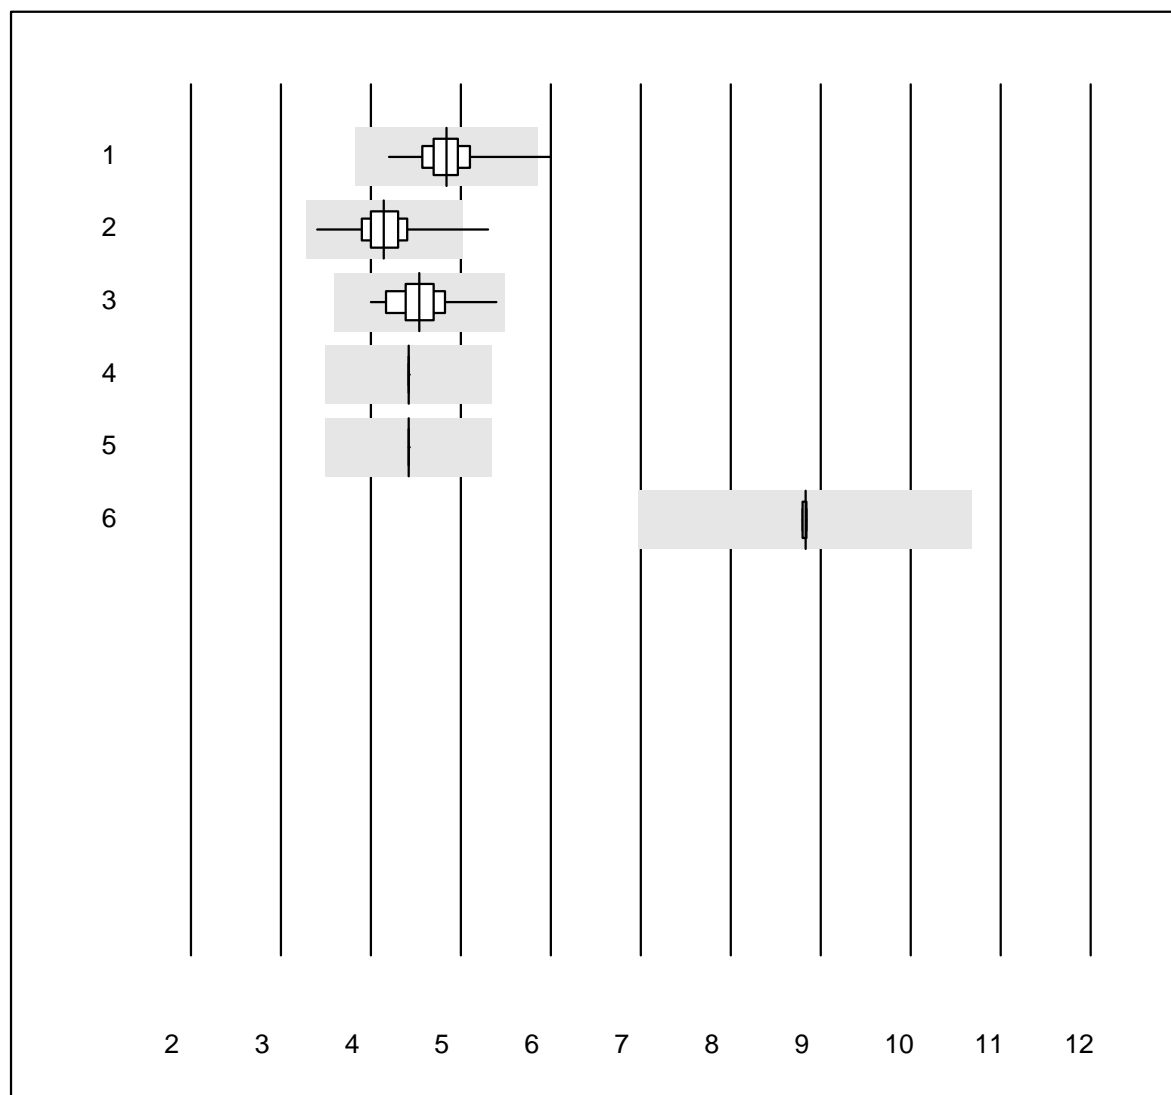

QUALAB Tolérance : 21 %

Créatinine urine (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	DCA2000/Vantage	146	96.6	0.7	2.7	4.8	5.1	e
2	Afinion	439	97.7	0.2	2.1	4.1	5.6	e
3	Chimie humide	40	100.0	0.0	0.0	4.5	6.3	e
4	Sysmex U	15	60.0	0.0	40.0	4.4	0.0	a
5	Aution	5	20.0	0.0	80.0	4.4	0.0	a
6	Siemens Clinitek	16	50.0	0.0	50.0	8.8	0.2	e