

Verein für
Association pour le
Associazione per il



medizinische Qualitätskontrolle
contrôle de qualité médical
controllo di qualità medico

Commentaire de l'essai interlaboratoire

2022 - 2

Échantillons de l'essai interlaboratoire

L'homogénéité et la stabilité ont été vérifiées pour tous les échantillons avant respectivement pendant l'envoi et aucune anomalie n'a été constatée. Les tests de conformité ont été réalisés par les laboratoires de l'Hôpital Universitaire de Zürich (<http://www.uzl.usz.ch/>).

Ont été produits spécifiquement pour MQ en sous-traitance les échantillons d'essai interlaboratoire suivants:

B1 Strep A Test, B2 Uricult, H4 Hématologie parasitaire, K14 Marqueur tumoral

Détermination des valeurs-cible

Pour chaque valeur-cible est indiqué le mode de détermination utilisé selon les termes de la norme ISO17043:2010, B2.1 (Colonne "Type"):

- a Valeur connue, sur la base de la production.
- b Valeur de référence certifiée lors de l'utilisation d'échantillons spécifiques
- c Valeur de référence déterminée par analyse
- d „Consensus value“ des laboratoires d'experts
- e „Consensus value“ des participants

Pour les groupes de méthode incluant plus de 9 participants, les valeurs cibles sont déterminées comme étant la „Consensus value“ ("e") des participants. Pour la détermination de ces valeurs cibles est utilisée la moyenne réalisée par le groupe de méthodes. Les résultats qui présentent un écart par rapport à la valeur cible supérieur à 1.5 fois la tolérance Qualab, sont considérés comme résultats aberrants et exclus du calcul de la valeur de référence. Les résultats des essais d'aptitude sont utilisés comme valeur de base pour éliminer les taux aberrants. Afin de mettre à disposition de tous les participants des valeurs-cible les plus pertinentes possibles, d'autres procédures peuvent également être utilisées pour des groupes de méthode plus restreints.

Incertitude dans la détermination des valeurs-cible

L'incertitude-type (u_x) est calculée à l'aide de la formule suivante (ISO13528):

$$u_x = (\text{Valeur-cible}/100) * (1.25/\text{Racine carrée du "nombre des participants"}) * \text{CV en \%}$$

- u_x est exprimée dans la même unité que la valeur-cible
- u_x peut être comparée avec l'écart-type du collectif des participants ($\text{Ecart-type} = \text{Valeur-cible} * \text{CV en \%} / 100$)
- Pour un nombre de participants >18 , l'incertitude-type (u_x) est significativement plus petite que la dispersion du collectif des participants et peut donc être négligée.


Tolérances QUALAB et MQ

Pour les analyses obligatoires sont utilisées les tolérances fixées par Qualab (www.qualab.ch, contrôle de qualité externe). Pour les analyses non-obligatoires, les tolérances sont fixées par le directeur de MQ pilotant l'essai interlaboratoire.

Si l'incertitude déterminée de la valeur de référence u_x est supérieure à 15% de la tolérance QUALAB ou de MQ, la lettre qui caractérise le type de détermination de la valeur-cible est en outre marquée d'une étoile (par exemple "e*"). Nous rendons ainsi les participants attentifs au fait que l'incertitude de la valeur de référence peut avoir une influence sur l'évaluation.

Représentation graphique

La représentation graphique des résultats est la suivante:

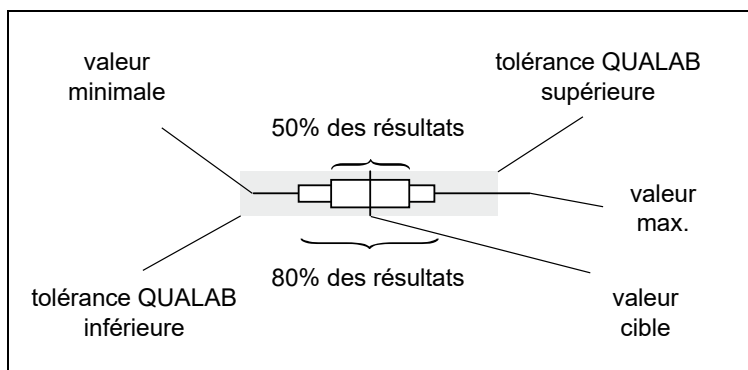


Comparaison des appareils

Les données de ce rapport vous permettent de comparer les performances respectives des divers appareils. Toutefois, vous devez tenir compte des points suivants:

- Le contrôle Chimie K1 est un sérum de contrôle commercialisé prêt à l'emploi. Même si l'échantillon est d'origine humaine, des effets matriciels sont possibles. Ceux-ci dépendent de l'appareil et peuvent générer des valeurs cible différentes.
- Seul un échantillon a été mesuré. La dispersion des résultats étant dépendante de la nature de l'échantillon (effets matriciels) et du niveau du résultat, les coefficients de variation déterminés (CV en %) ne sont pas toujours valables.
- Une grande partie des taux aberrants est due à des erreurs administratives (erreur d'unité, confusion des résultats) ou à des erreurs de manipulation (erreur d'échantillon, dissolution incorrecte, mélange insuffisant) et n'a rien à voir avec le type d'appareil.


Zürich, 4.7.2022



Dr. R. Fried
Directeur de l'essai interlaboratoire

Il n'est pas autorisé de publier une partie ou l'intégralité de ce rapport sans notre accord écrit préalable. L'original est conservé dans les archives sous www.mqzh.ch.

Quick OA

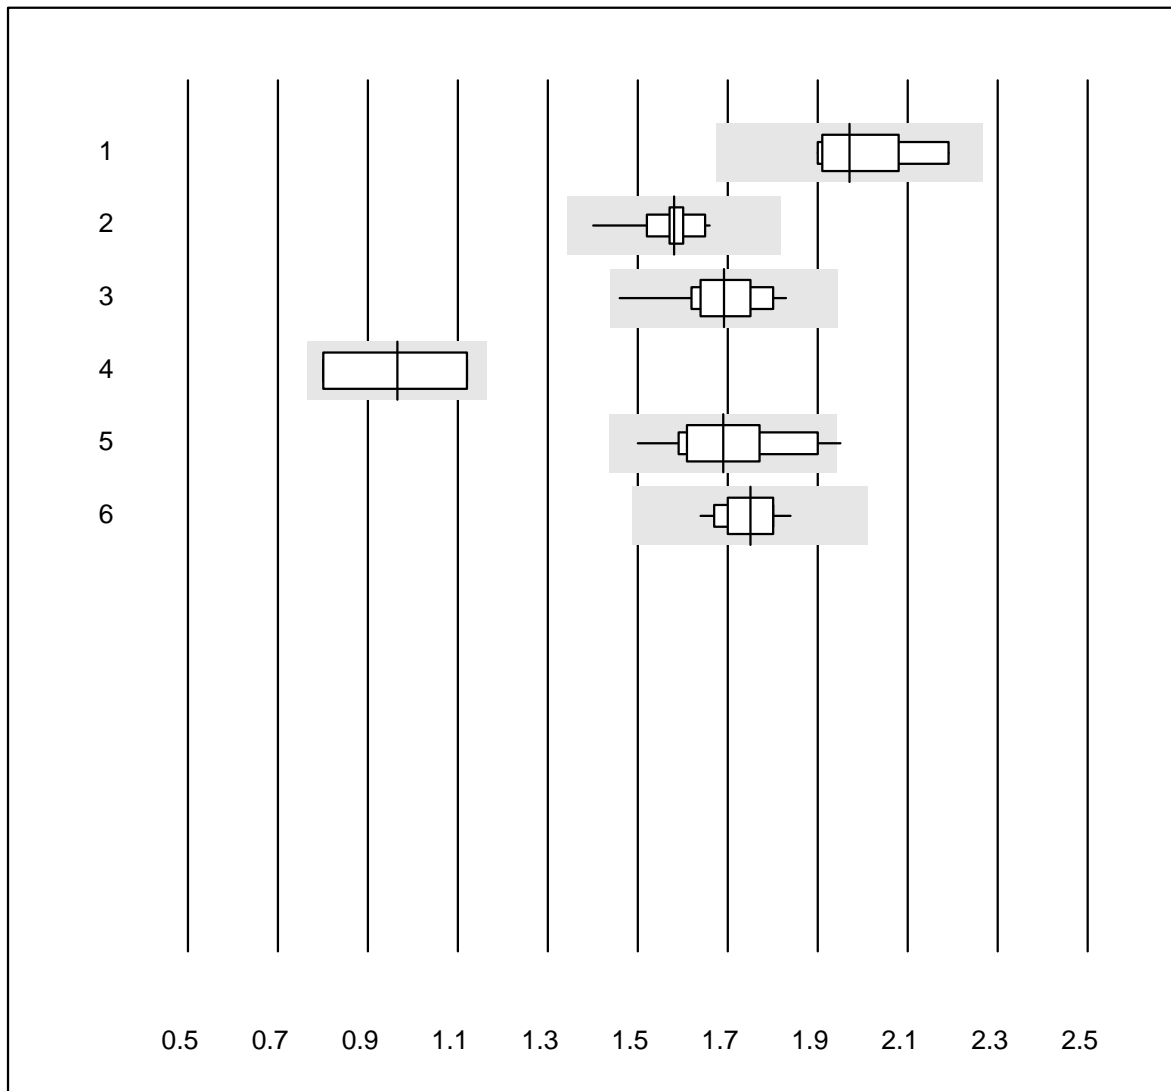


QUALAB Tolérance : 15 %
(< 1.30: +/- 0.20)

Quick OA ()


No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	Neoplastin Plus	5	100.0	0.0	0.0	1.97	6.1	e*
2	Innovin	14	100.0	0.0	0.0	1.58	4.0	e
3	Recombiplastin 2G	12	100.0	0.0	0.0	1.69	5.8	e
4	Eurolyser	4	75.0	0.0	25.0	0.97	20.0	e*
5	Autres méthodes	14	92.9	7.1	0.0	1.69	7.4	e*
6	Neoplastin R	12	100.0	0.0	0.0	1.75	3.4	e

Fibrinogène OA

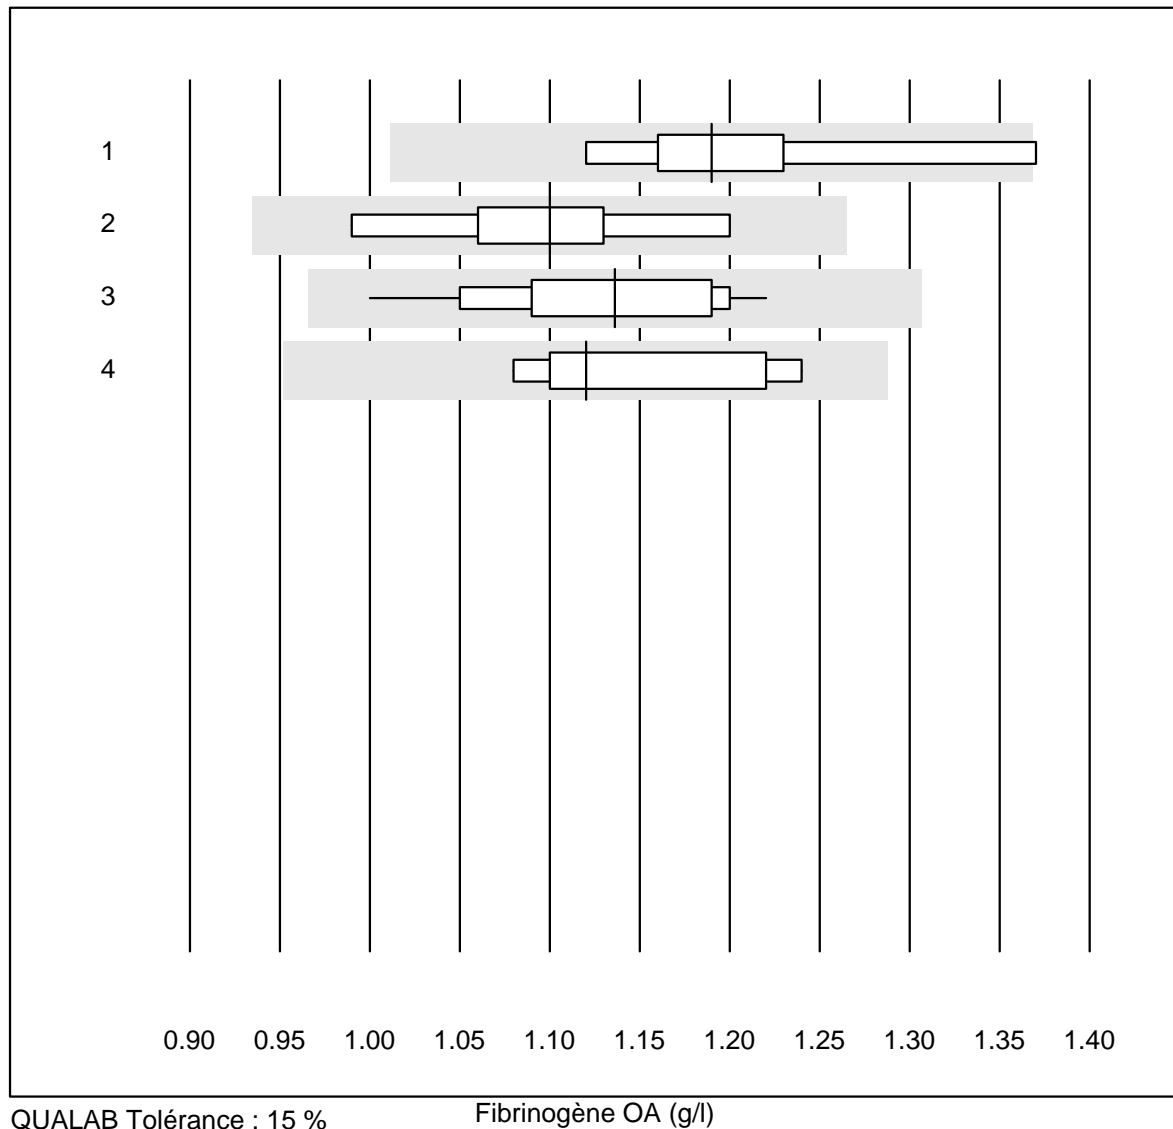

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Autres méthodes	7	85.7	14.3	0.0	1.19	6.6	e*
2 Siemens Thrombin	6	100.0	0.0	0.0	1.10	6.5	e*
3 Stago/STA	16	100.0	0.0	0.0	1.14	5.7	e
4 Fibrinogen Q.F.A.	5	100.0	0.0	0.0	1.12	6.3	e*

aPTT OA

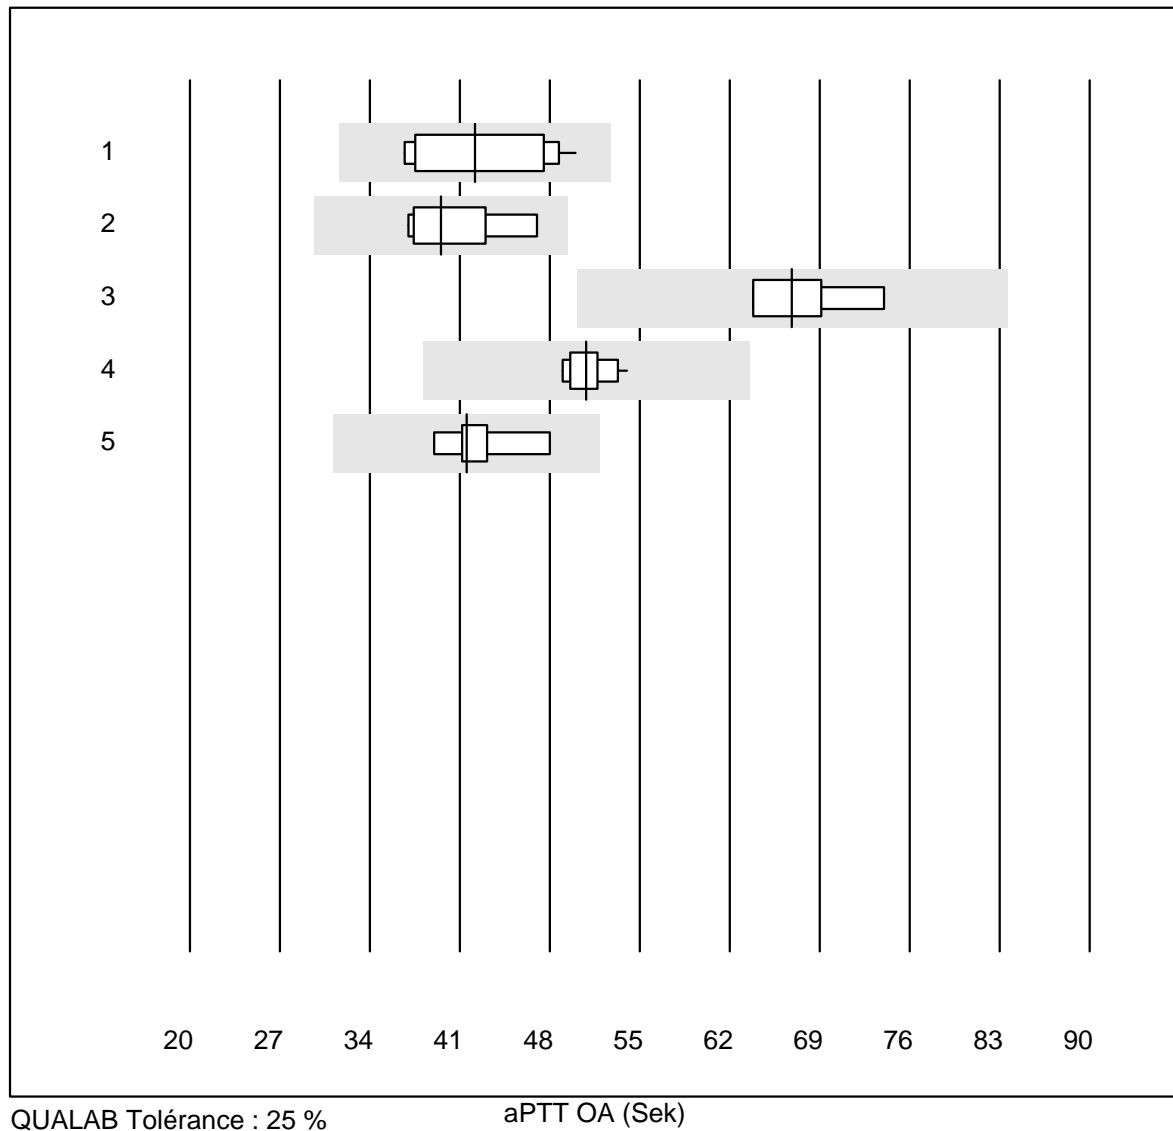


QUALAB Tolérance : 25 %

aPTT OA (Sek)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Autres méthodes	10	100.0	0.0	0.0	42.2	12.2	e*
2 Actin FS	6	100.0	0.0	0.0	39.5	9.7	e*
3 Pathromtin SL	4	100.0	0.0	0.0	66.9	6.9	e*
4 Stago/STA	15	100.0	0.0	0.0	50.8	3.0	e
5 aPTT-SP	7	100.0	0.0	0.0	41.5	6.6	e

INR CoaguChek

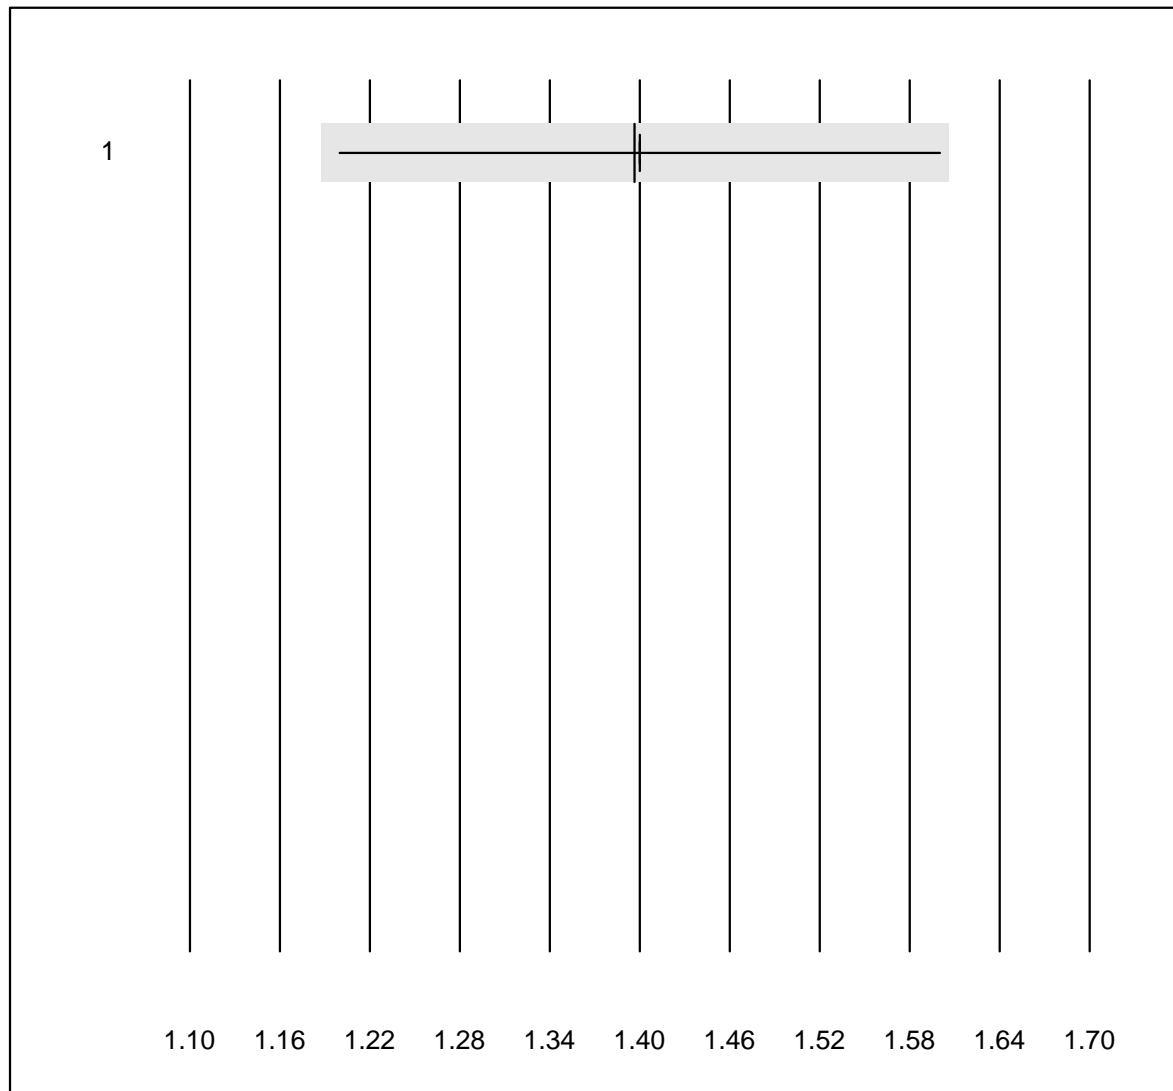


QUALAB Tolérance : 15 %

INR CoaguChek ()

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 CoaguChek Pro II	741	98.8	0.0	1.2	1.4	2.1	e

Quick N

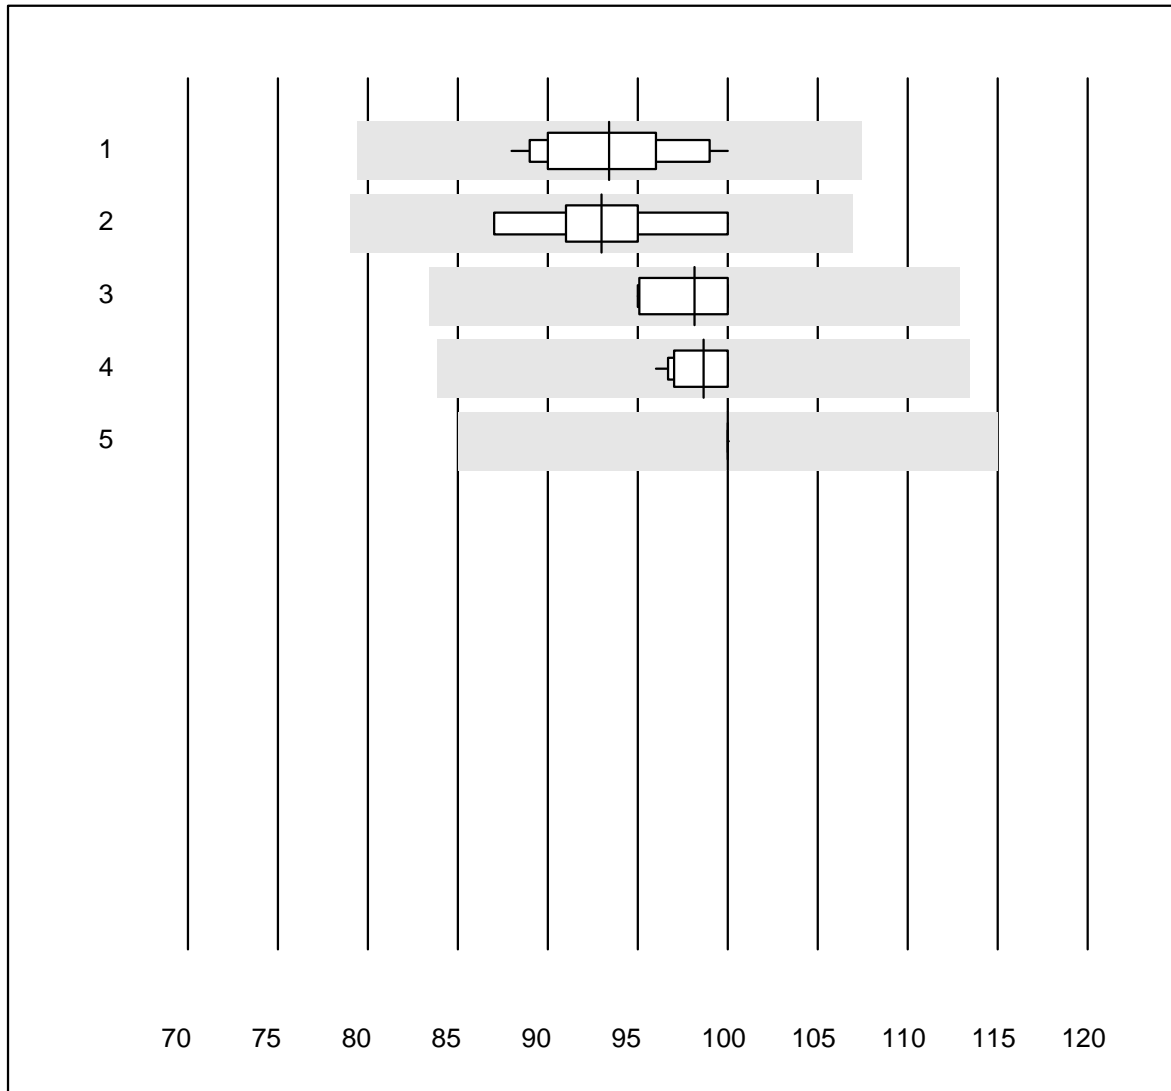


QUALAB Tolérance : 15 %

Quick N (%)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Neoplastin R	12	100.0	0.0	0.0	93	4.6	e
2 Neoplastin Plus	6	100.0	0.0	0.0	93	4.7	e*
3 Innovin	10	100.0	0.0	0.0	98	2.3	e
4 toutes les méthodes	12	100.0	0.0	0.0	99	1.6	e
5 Recombiplastin 2G	8	100.0	0.0	0.0	100	0.0	e

Faktor II

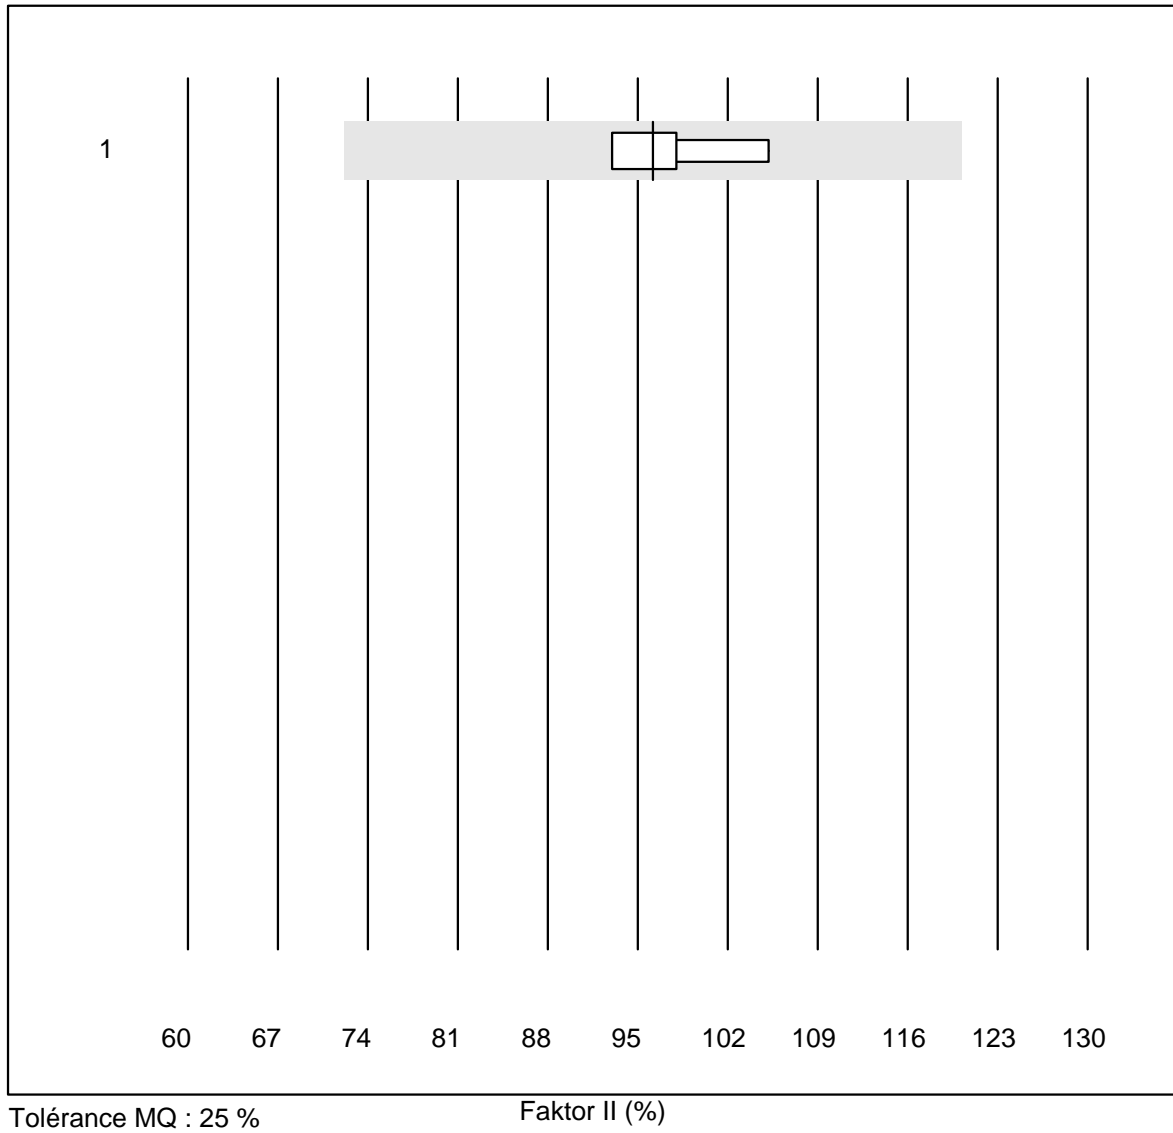


Tolérance MQ : 25 %

Faktor II (%)


No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	96.2	5.6	e

Fibrinogen N

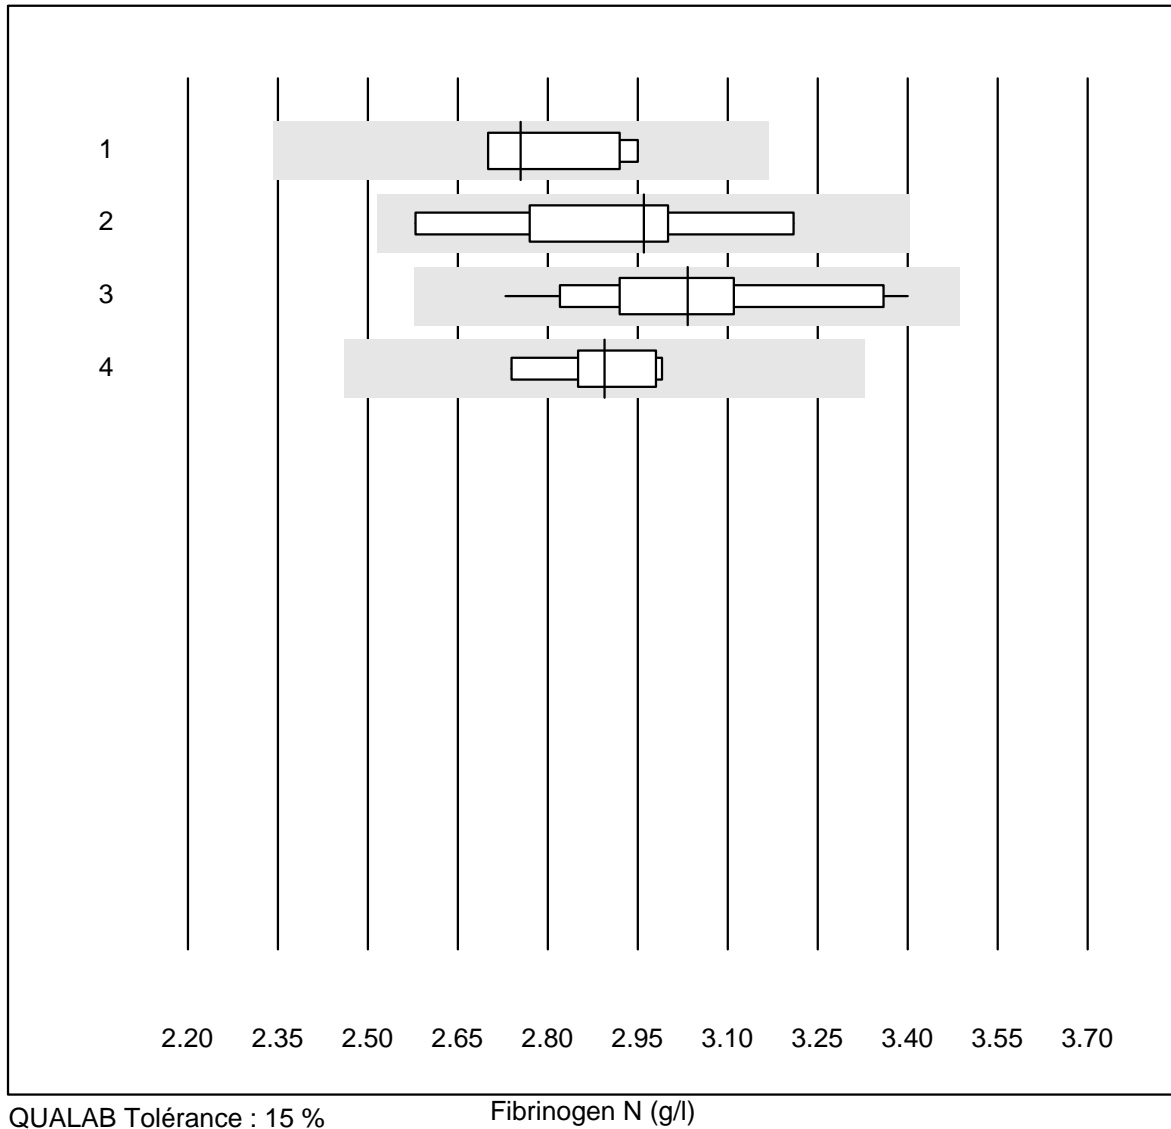

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Siemens Thrombin	6	100.0	0.0	0.0	2.76	4.0	e
2 Autres méthodes	9	100.0	0.0	0.0	2.96	6.4	e*
3 Stago/STA	19	100.0	0.0	0.0	3.03	5.6	e
4 Fibrinogen Q.F.A.	6	100.0	0.0	0.0	2.90	3.2	e

Faktor V

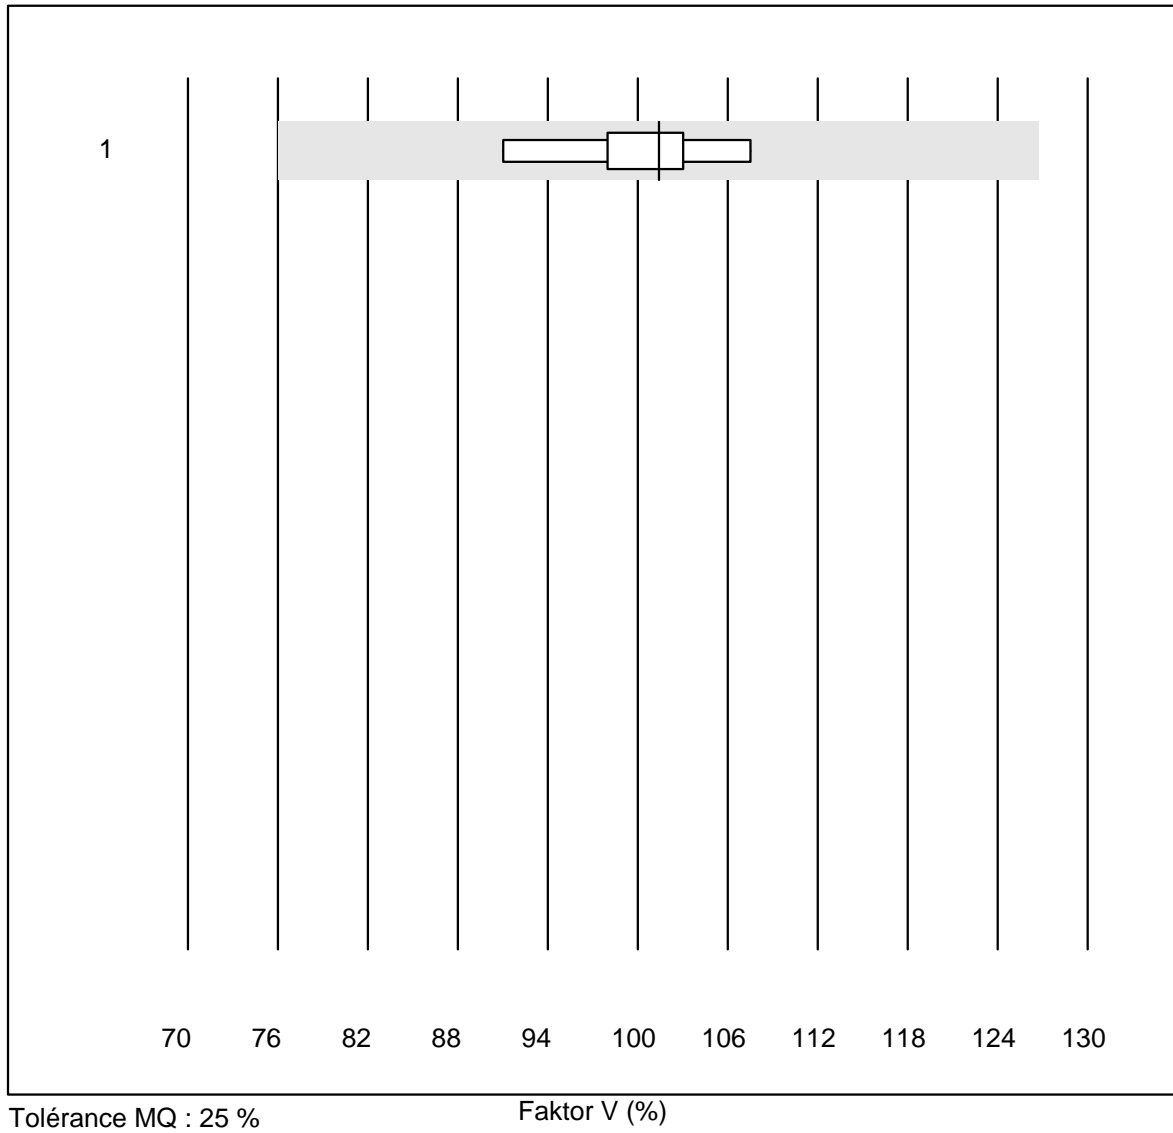


Tolérance MQ : 25 %

Faktor V (%)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	8	100.0	0.0	0.0	101.4	4.8	e

aPTT N

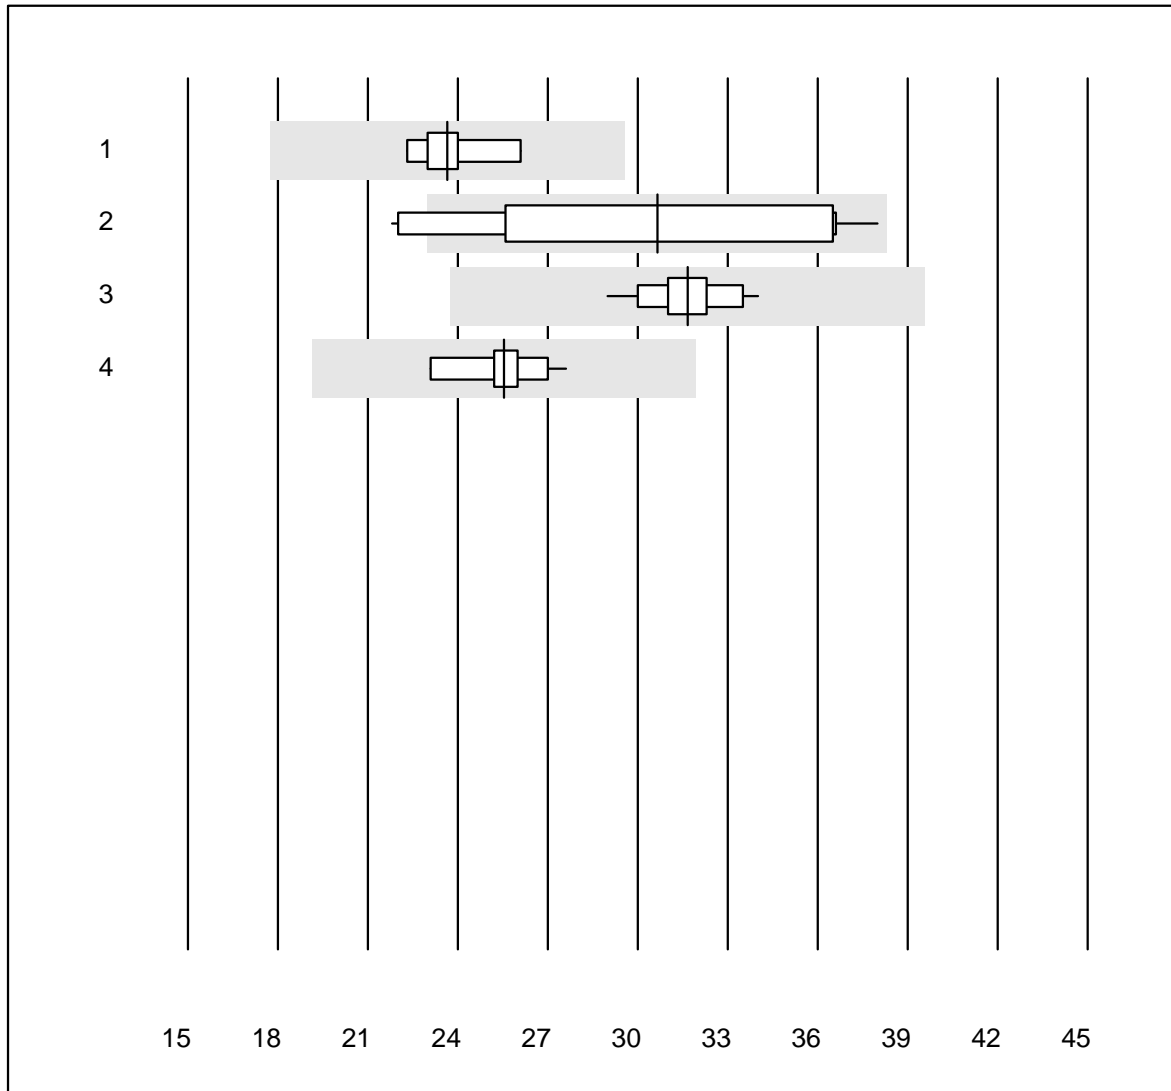


QUALAB Tolérance : 25 %

aPTT N (Sek)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Actin FS	6	100.0	0.0	0.0	23.7	5.4	e
2 Autres méthodes	11	81.8	18.2	0.0	30.7	20.4	e*
3 Stago/STA	19	100.0	0.0	0.0	31.7	3.8	e
4 aPTT-SP	10	100.0	0.0	0.0	25.6	5.1	e

Faktor VII

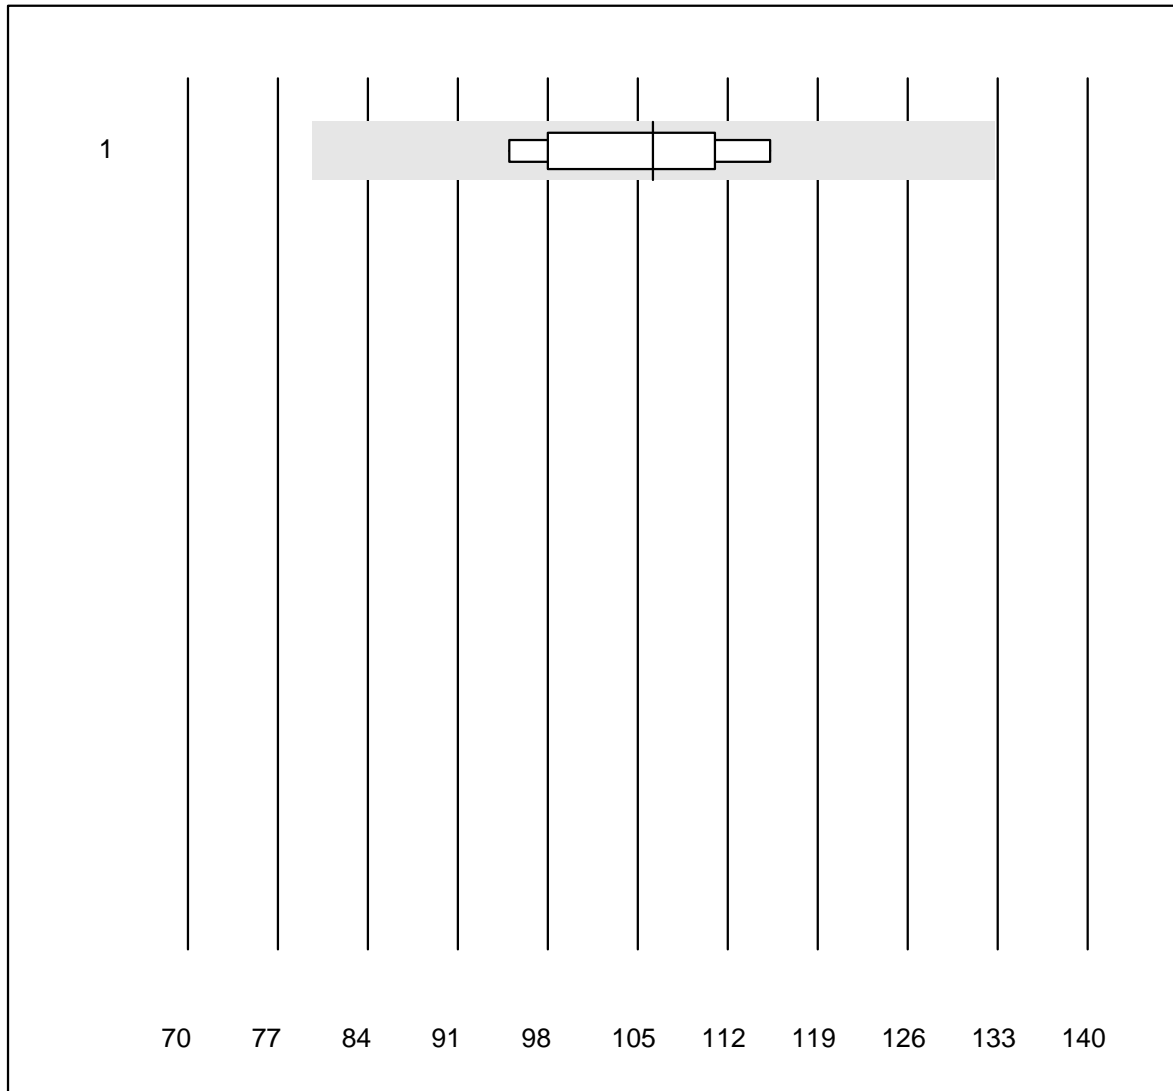


Tolérance MQ : 25 %

Faktor VII (%)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	106.2	8.1	e*

Quick H

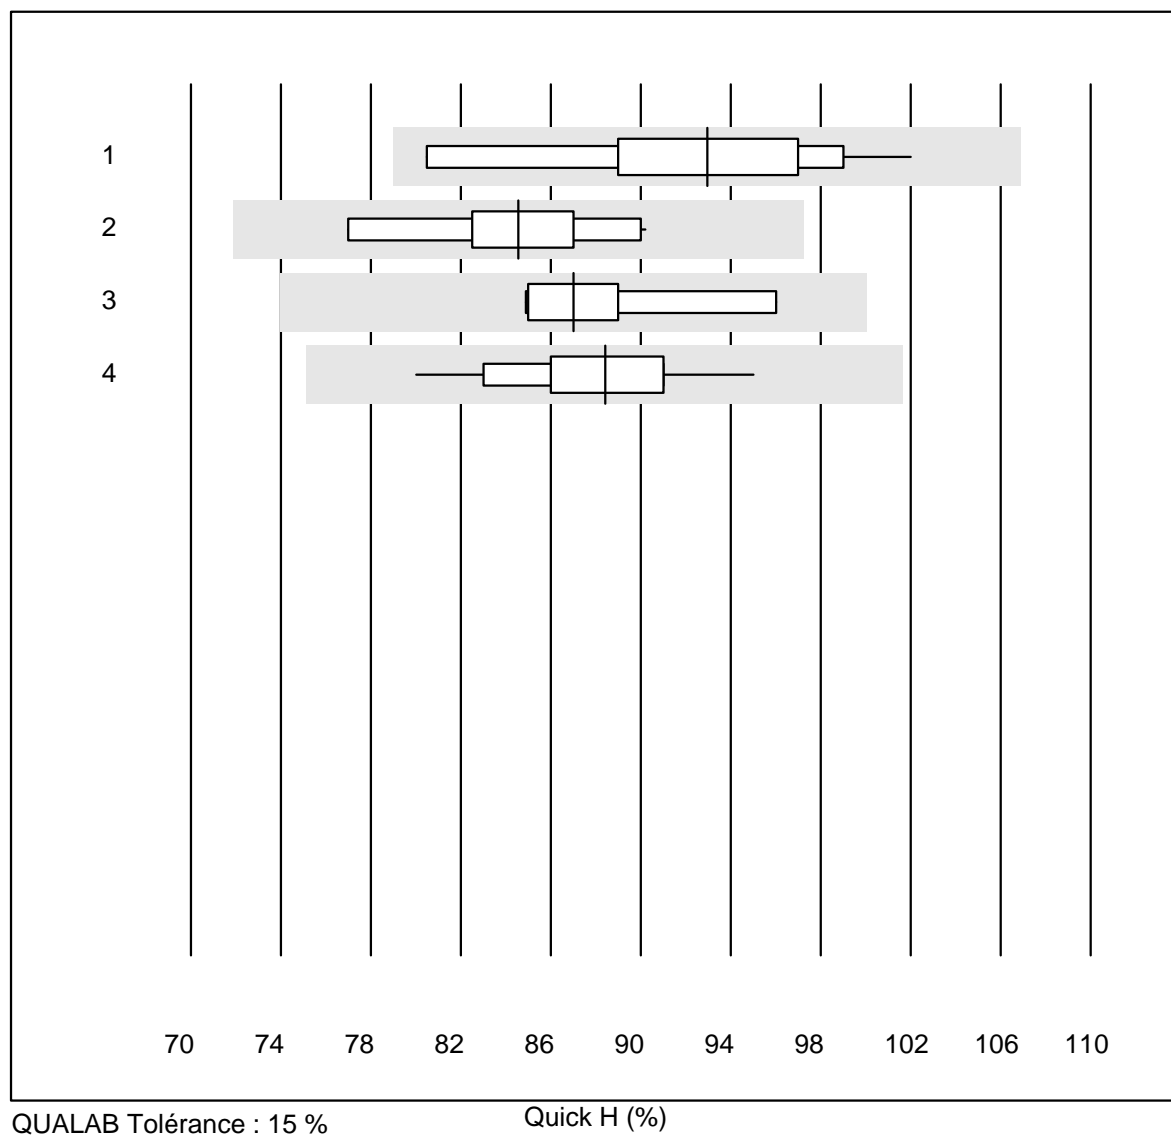


QUALAB Tolérance : 15 %

Quick H (%)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Neoplastin R	10	100.0	0.0	0.0	93	6.7	e*
2 Innovin	11	90.9	0.0	9.1	85	5.1	e
3 toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	87	4.5	e
4 Recombiplastin 2G	12	100.0	0.0	0.0	88	4.5	e

Anti-FXa (unfrakt-Heparin)

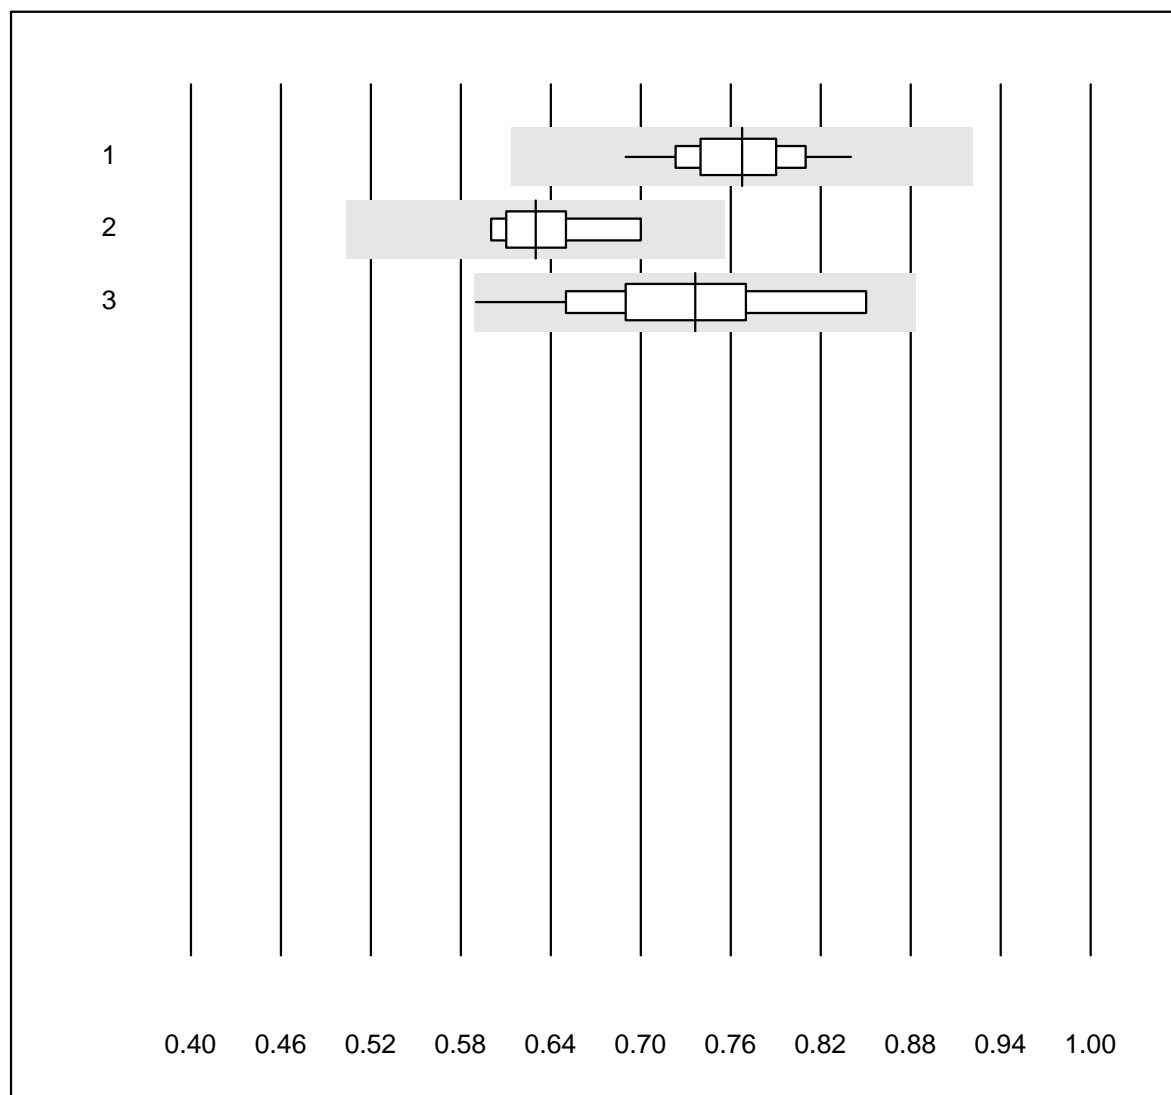


Tolérance MQ : 20 %

Anti-FXa (unfrakt-Heparin) (IU/ml)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	11	100.0	0.0	0.0	0.77	5.4	e
2 Stago/STA	8	100.0	0.0	0.0	0.63	6.0	e
3 ACL	16	100.0	0.0	0.0	0.74	9.5	e

Fibrinogen H

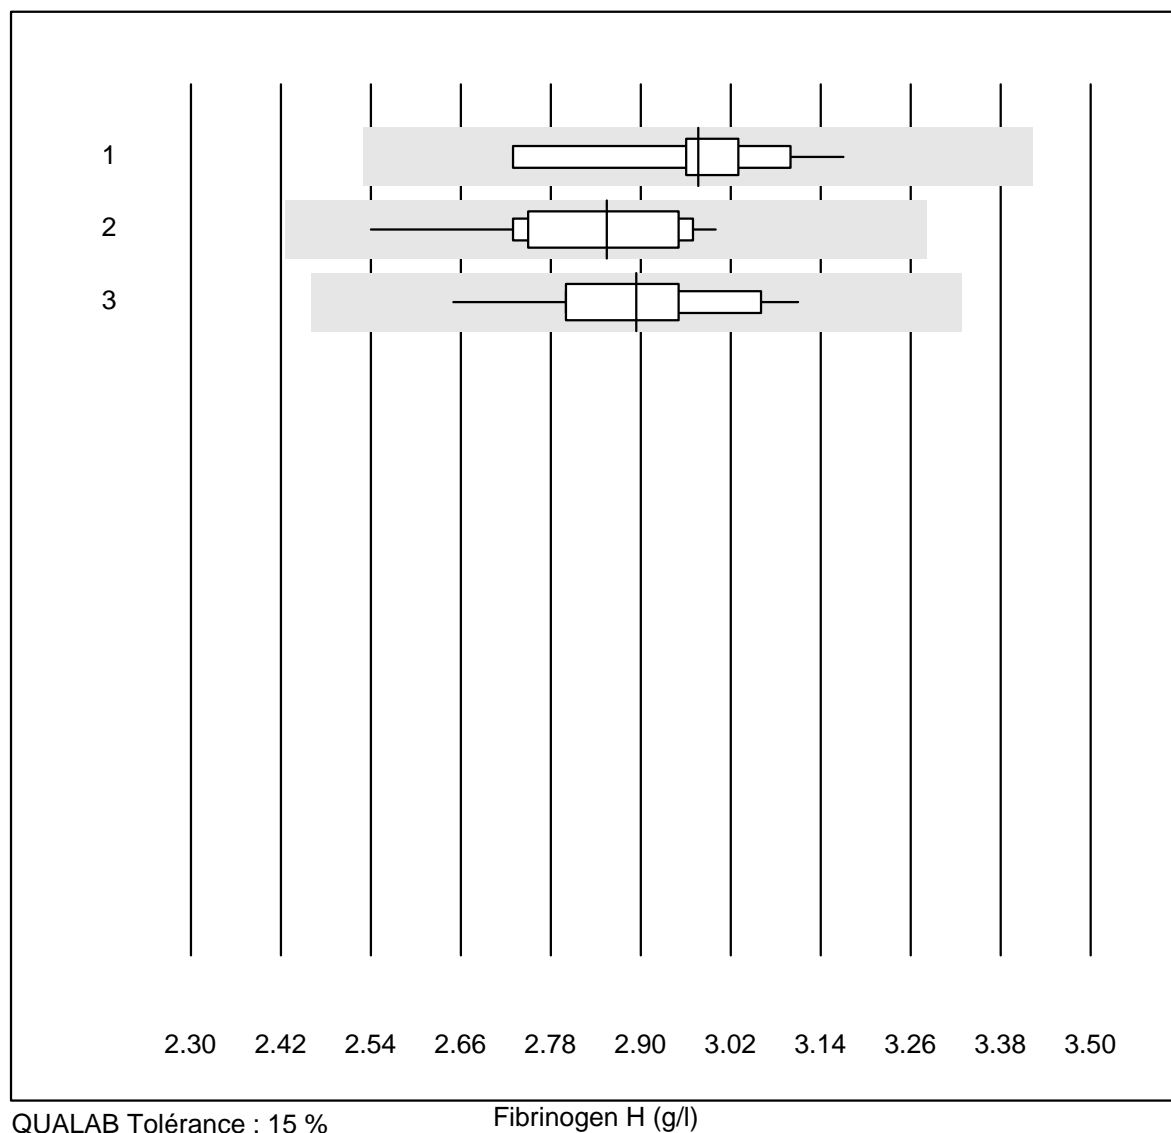


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Autres méthodes	10	100.0	0.0	0.0	2.98	4.2	e
2 Stago/STA	12	100.0	0.0	0.0	2.85	4.5	e
3 Fibrinogen Q.F.A.	12	100.0	0.0	0.0	2.89	4.3	e

aPTT H

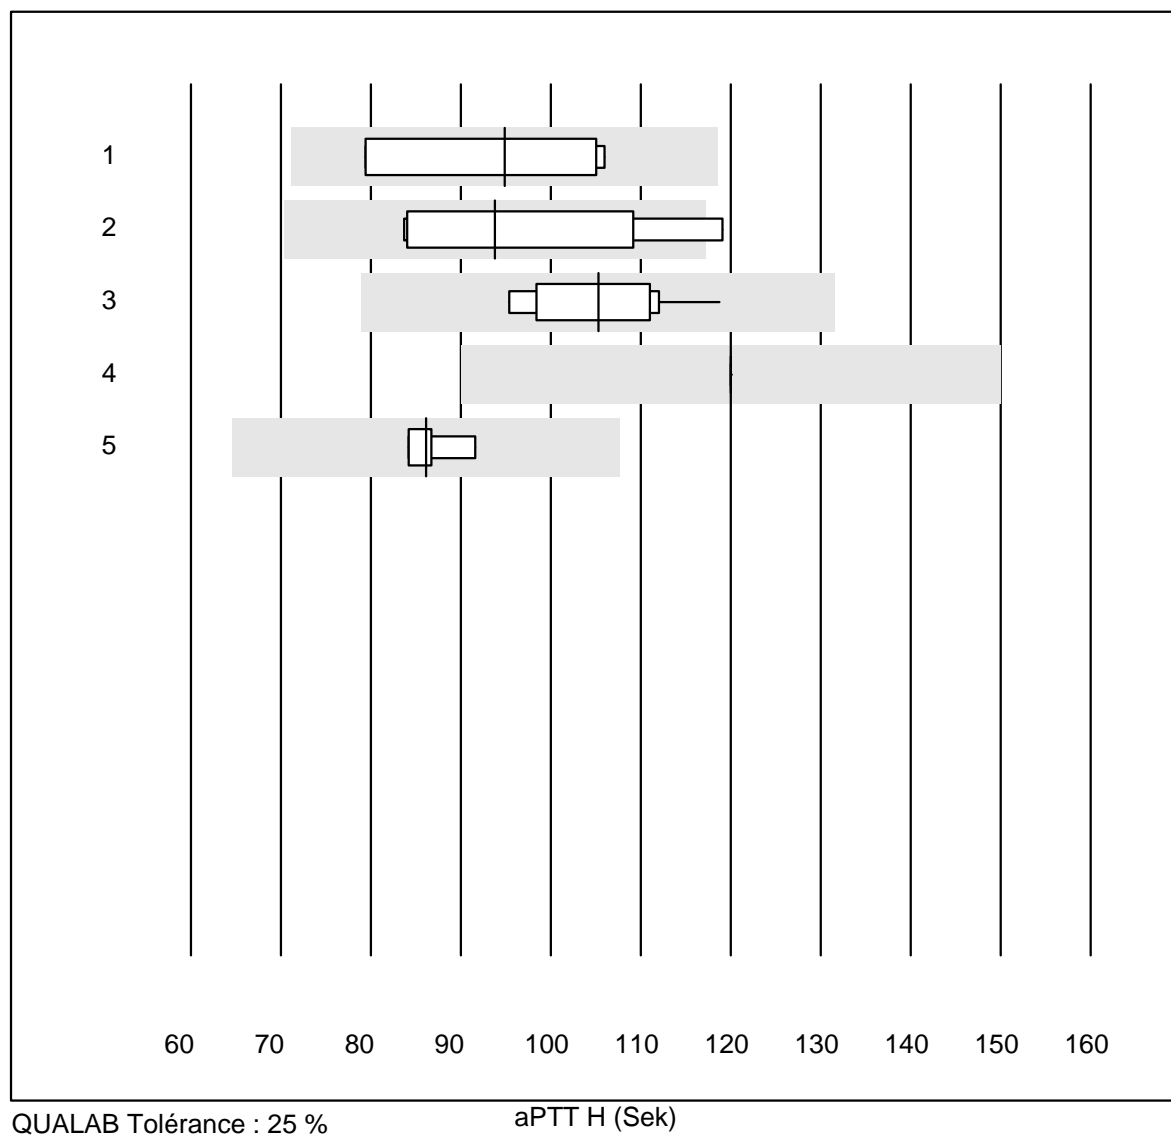


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Actin FS	4	100.0	0.0	0.0	94.9	14.6	e*
2 Autres méthodes	6	83.3	16.7	0.0	93.8	15.9	e*
3 Stago/STA	10	100.0	0.0	0.0	105.3	7.1	e
4 aPTT-SP	12	100.0	0.0	0.0	120.0	0.0	e
5 Actin FSL	4	100.0	0.0	0.0	86.2	3.7	e

D-Dimères

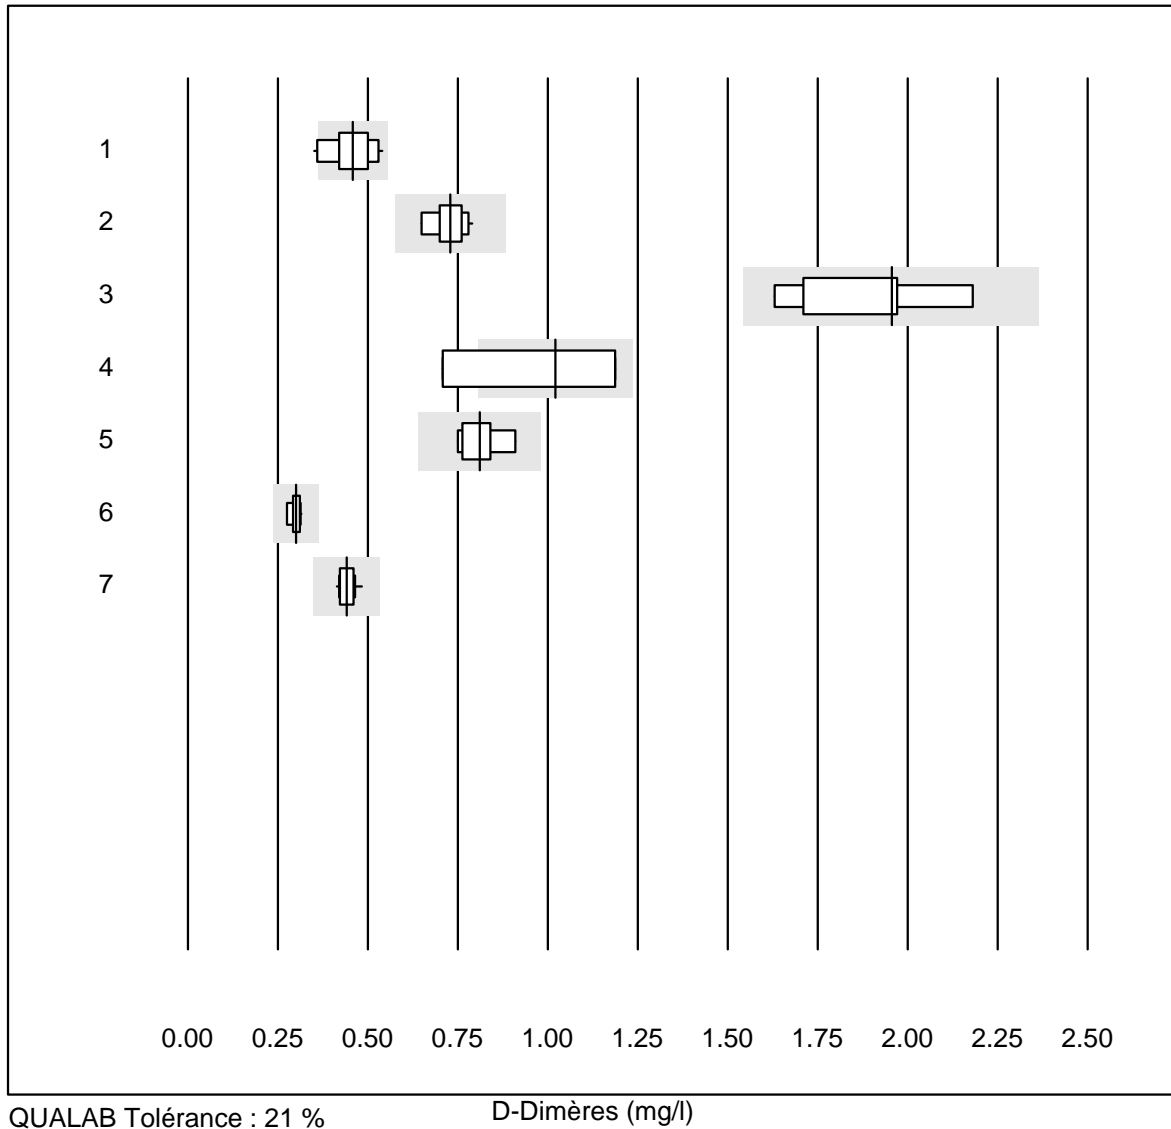


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 STA Liatest	15	86.7	13.3	0.0	0.46	12.5	e*
2 Siemens Innovance	11	90.9	0.0	9.1	0.73	6.5	e
3 Pathfast	8	87.5	0.0	12.5	1.96	9.6	e*
4 Eurolyser	4	50.0	25.0	25.0	1.02	26.7	e*
5 ACL	9	100.0	0.0	0.0	0.81	6.2	e
6 AQT 90 FLEX	10	100.0	0.0	0.0	0.30	4.5	e
7 VIDAS	15	100.0	0.0	0.0	0.44	4.8	e

CoaguChek APTT

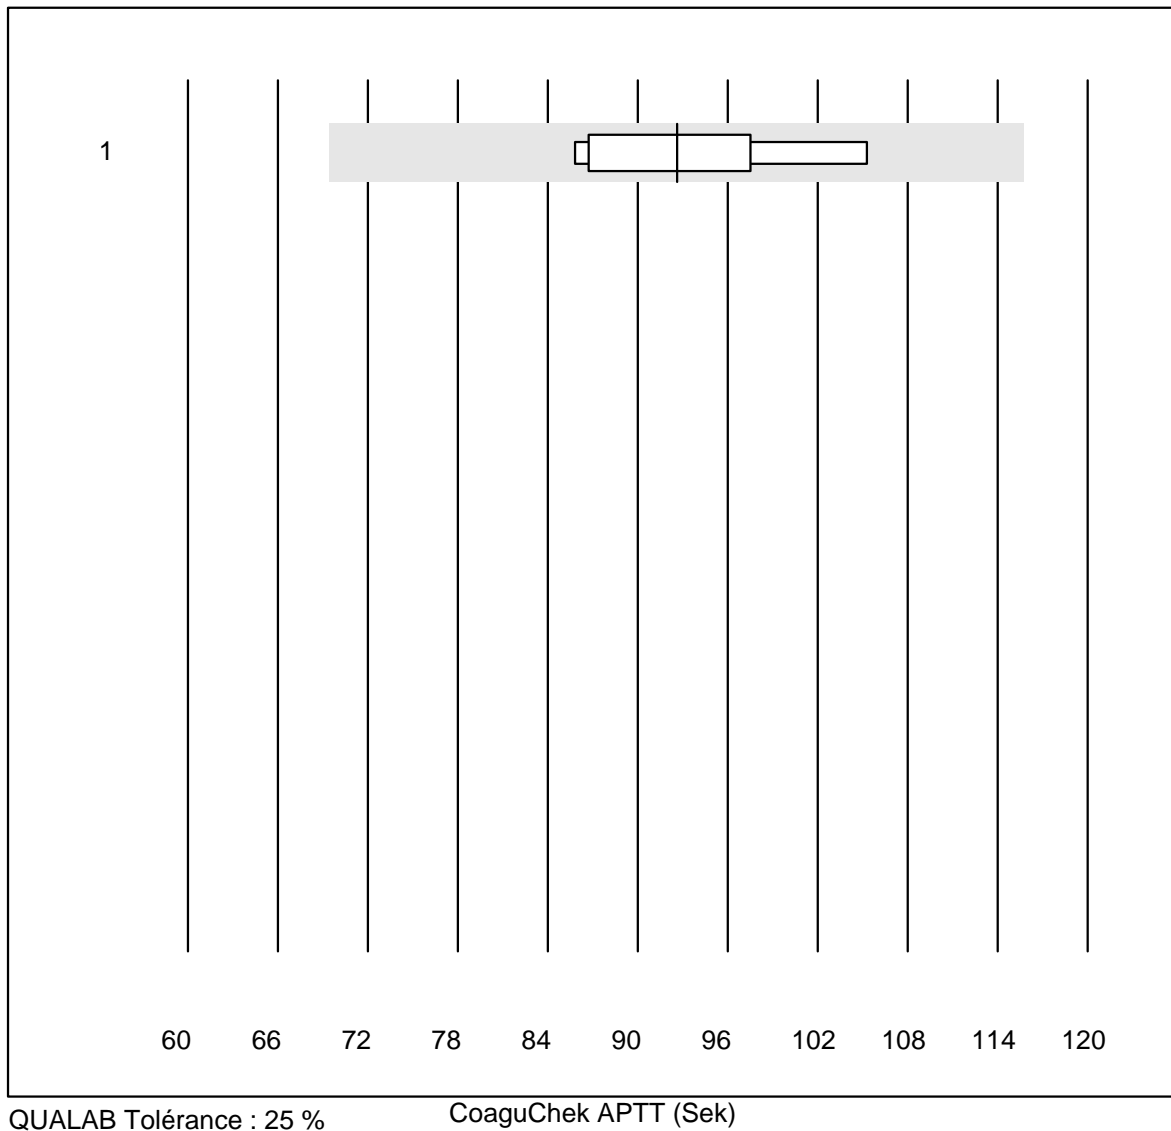

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 CoaguChek Pro II	7	85.7	0.0	14.3	92.6	8.1	e*

INR CCXS

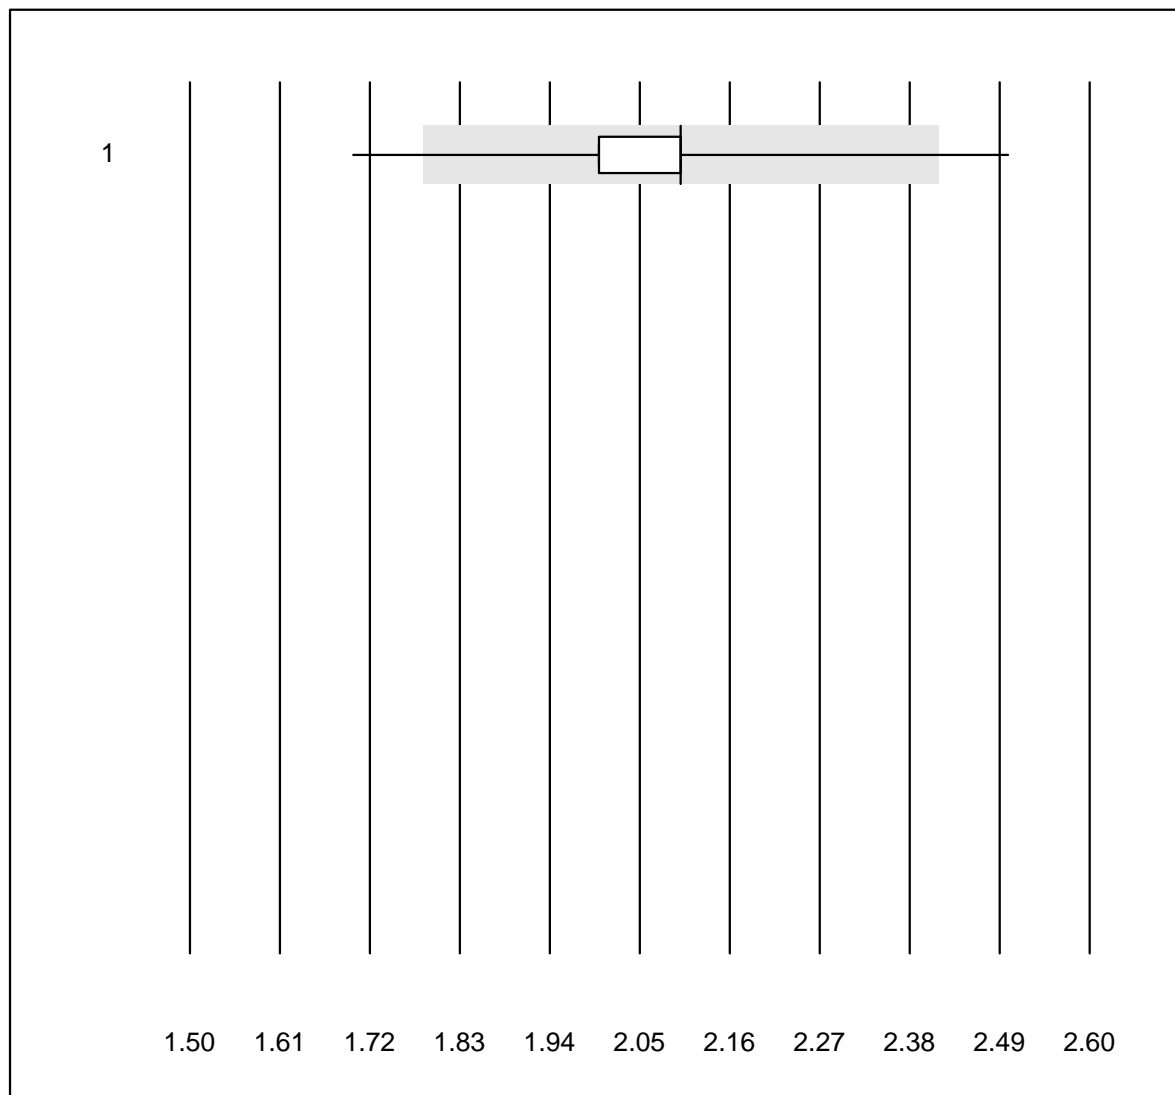


QUALAB Tolérance : 15 %

INR CCXS ()

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 CoaguChek XS	1585	99.0	0.3	0.7	2.1	3.2	e

INR HC

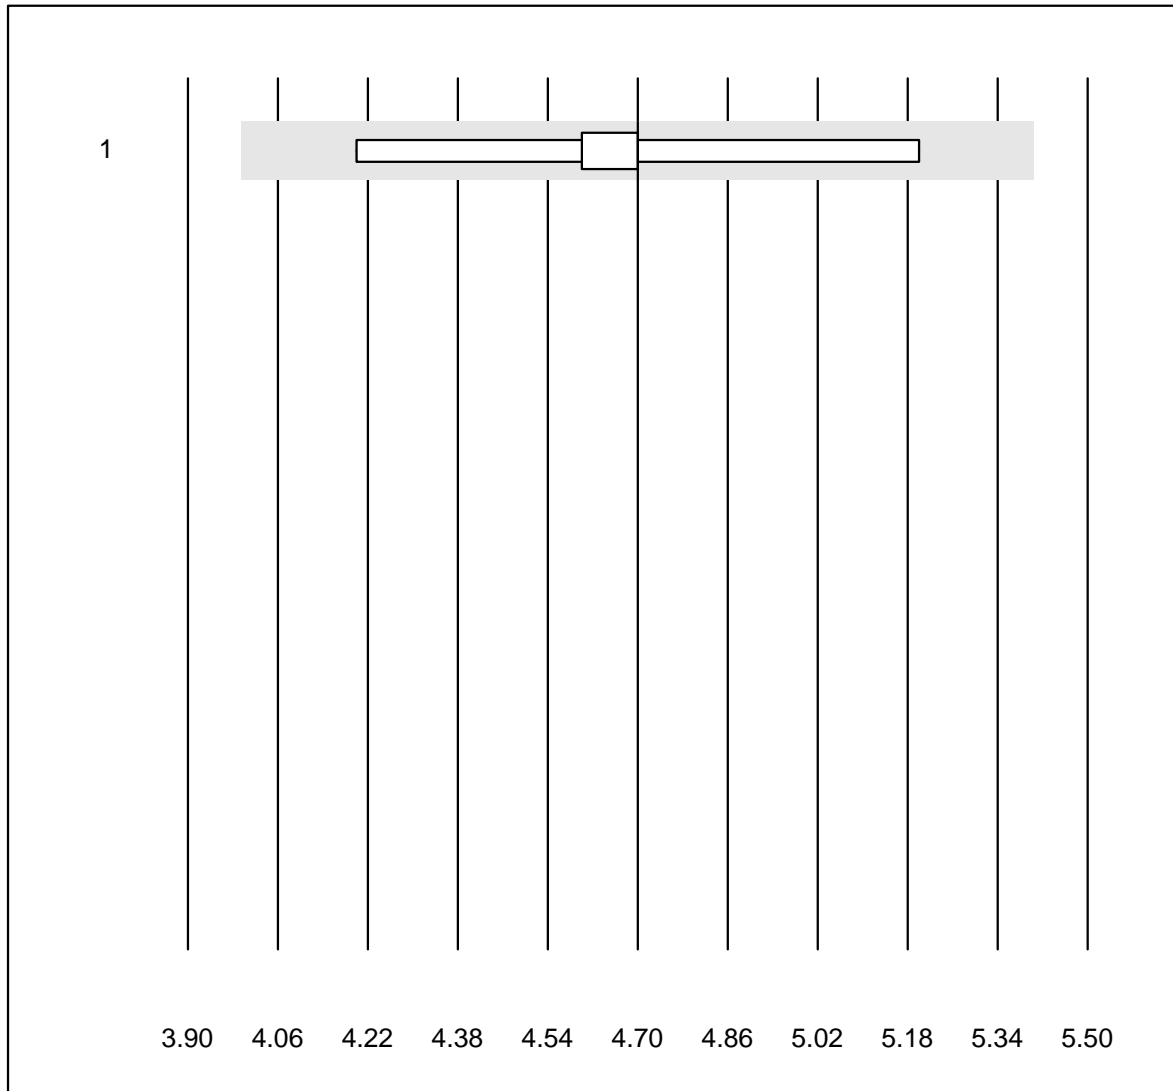


QUALAB Tolérance : 15 %

INR HC ()

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Hemochron j.	8	100.0	0.0	0.0	4.7	5.9	e*

INR MI

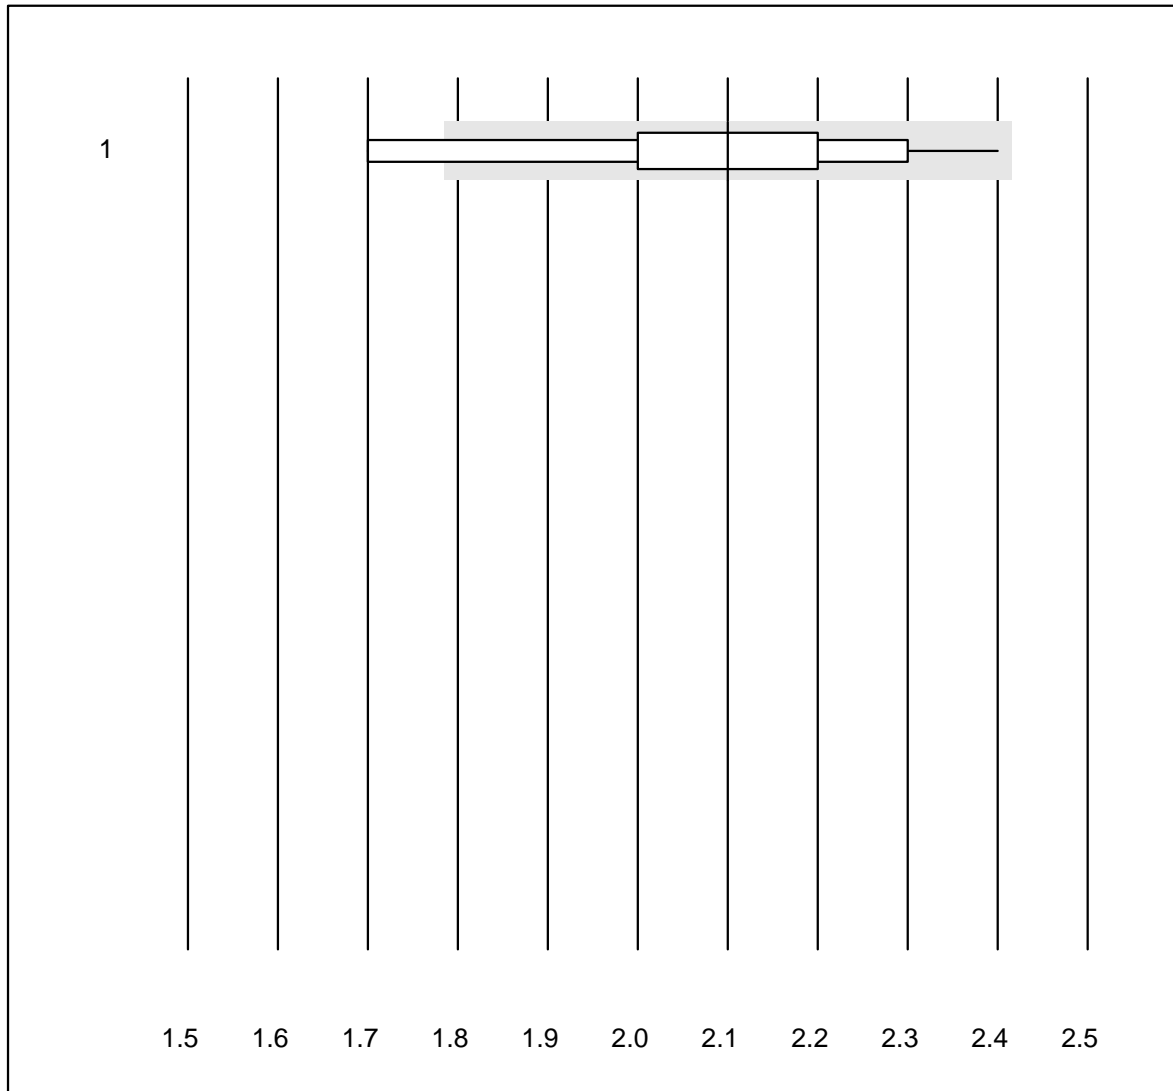


QUALAB Tolérance : 15 %

INR MI ()

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 MicroINR	131	75.6	8.4	16.0	2.1	9.0	e

INR Xprecia

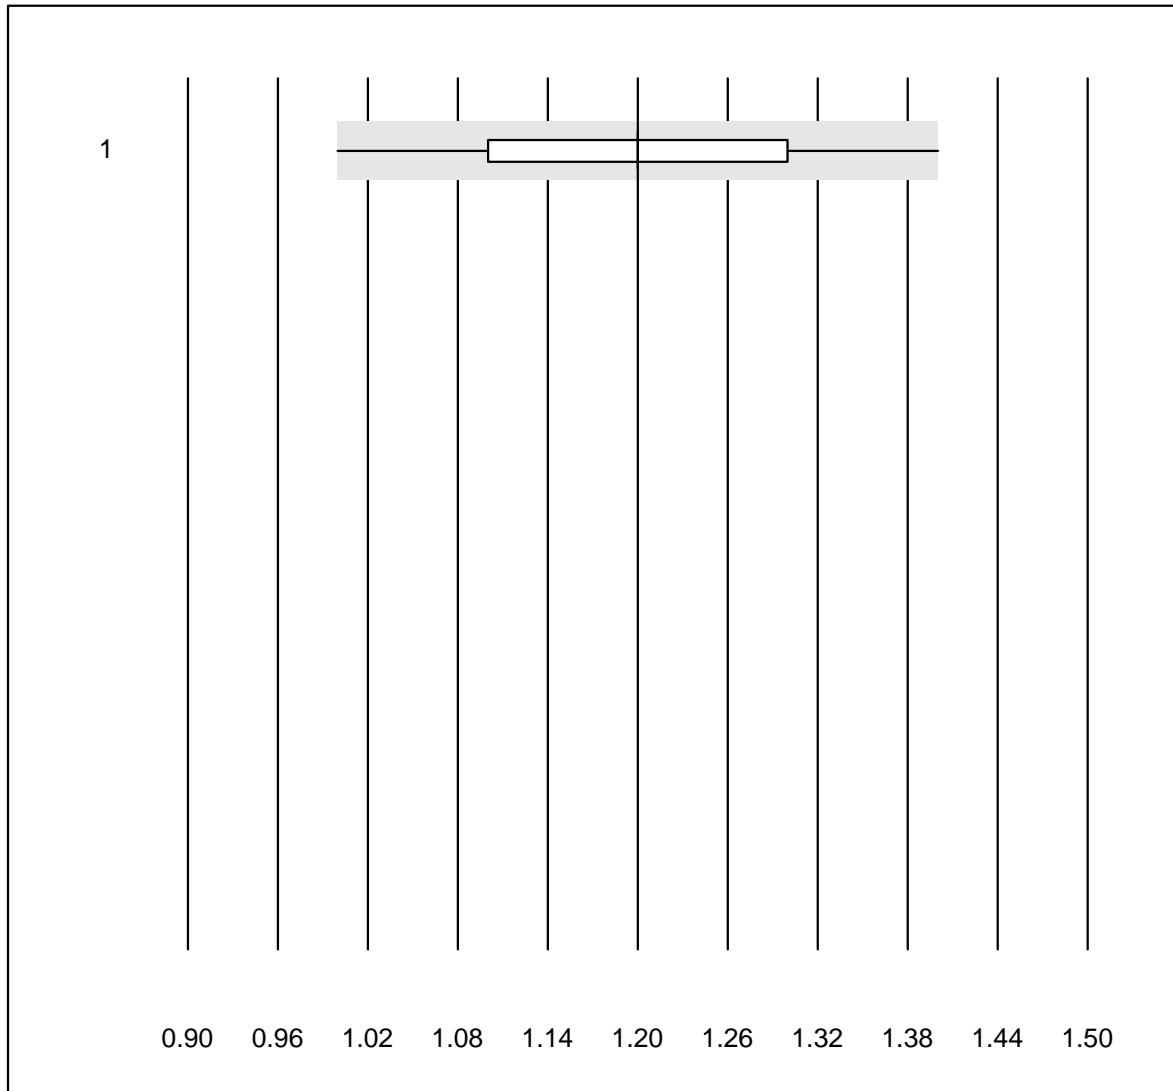


QUALAB Tolérance : 15 %
(< 1.3: +/- 0.2)

INR Xprecia ()

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Xprecia	58	91.4	5.2	3.4	1.2	5.9	e

INR Lumira Dx

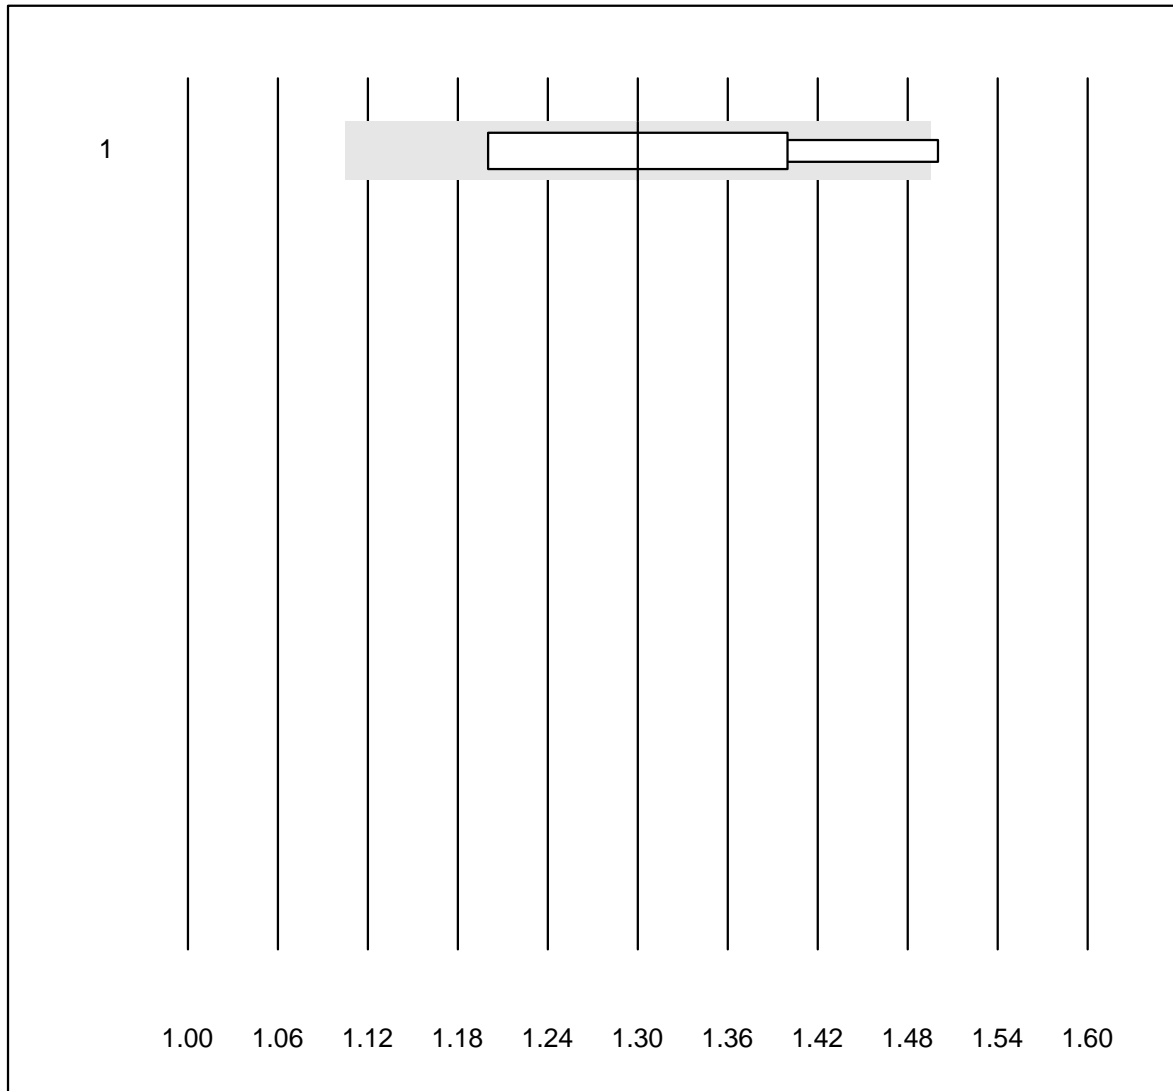


QUALAB Tolérance : 15 %

INR Lumira Dx ()

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Lumira Dx	6	83.3	16.7	0.0	1.3	8.9	e*

Anti-FXa (LMW-Heparin)

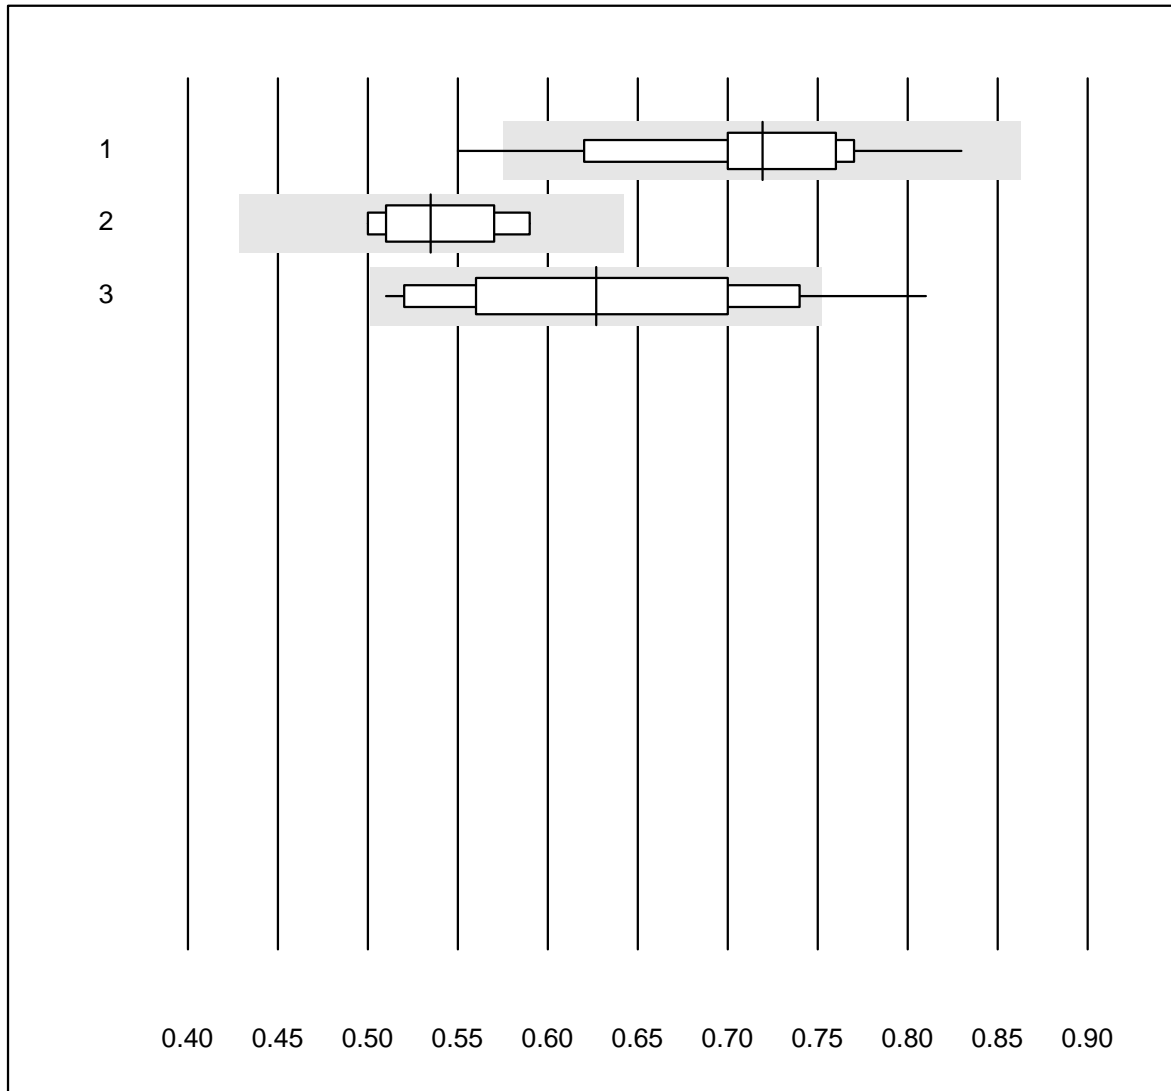


Tolérance MQ : 20 %

Anti-FXa (LMW-Heparin) (IU/ml)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	14	92.9	7.1	0.0	0.72	9.7	e*
2 Stago/STA	8	100.0	0.0	0.0	0.54	6.2	e
3 ACL	13	84.6	7.7	7.7	0.63	15.4	e*

Anti-FXa (Rivaroxaban)

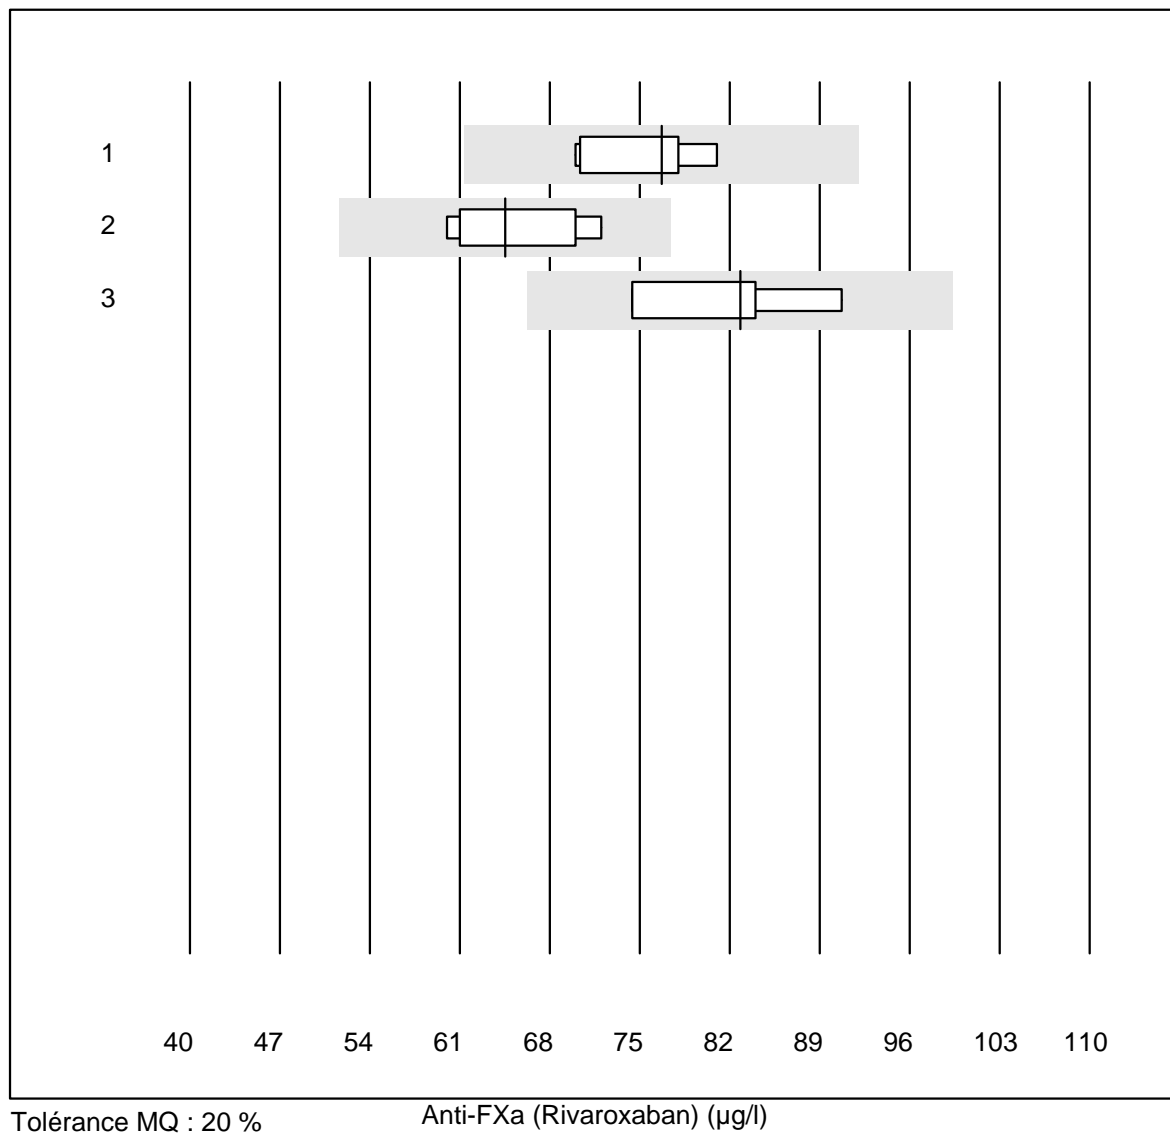

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	8	100.0	0.0	0.0	76.70	5.6	e
2 Stago/STA	8	100.0	0.0	0.0	64.50	7.2	e*
3 ACL	4	100.0	0.0	0.0	82.80	8.1	e*

Anti-FXa (Apixaban)

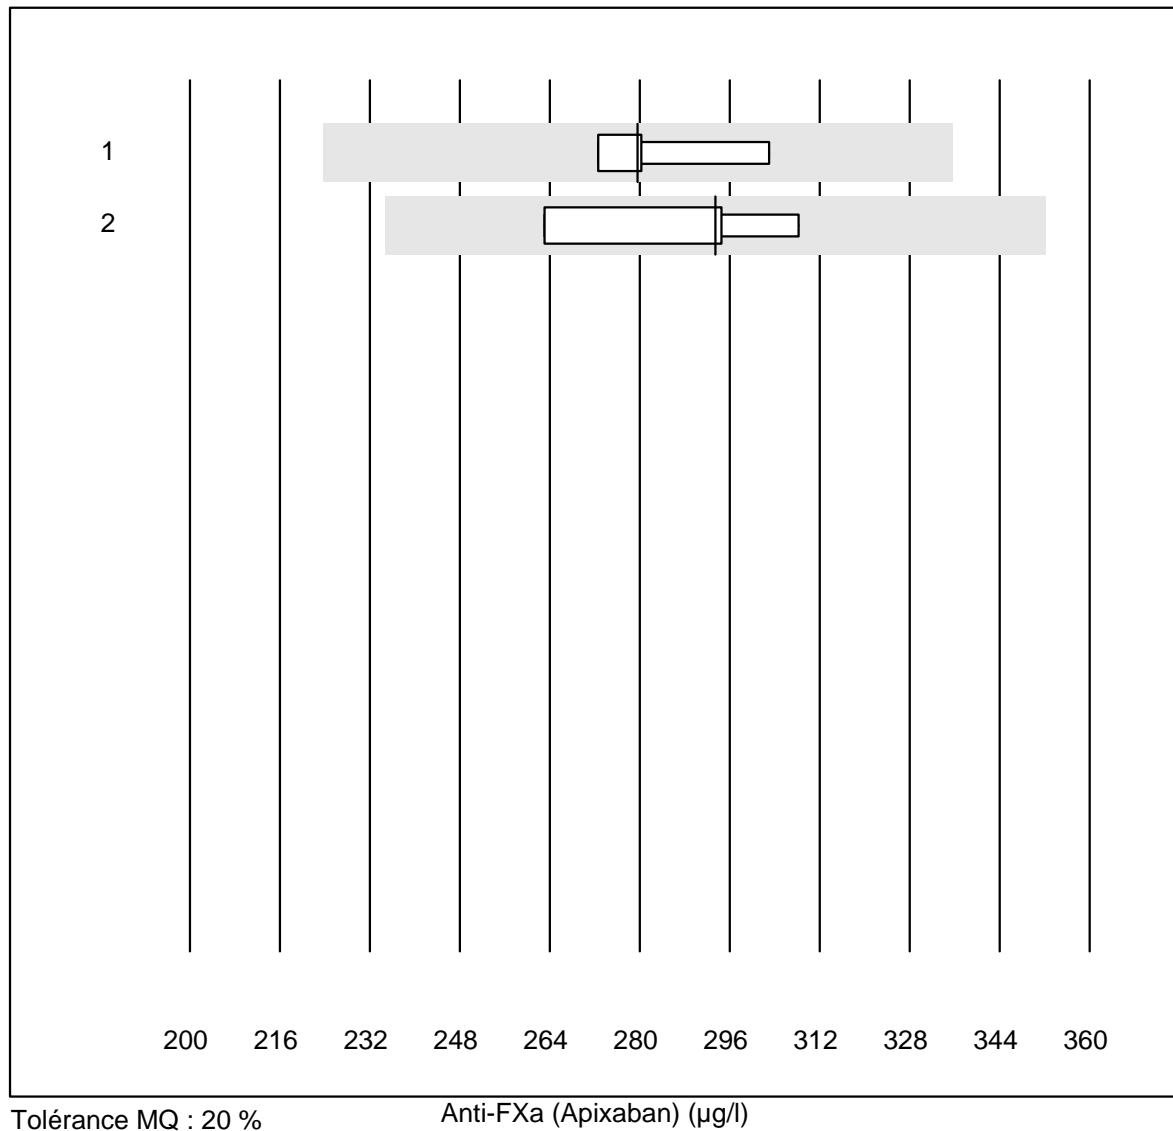


Tolérance MQ : 20 %

Anti-FXa (Apixaban) (µg/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	279.65	4.7	e
2 ACL	4	100.0	0.0	0.0	293.40	6.6	e*

Hémoglobine

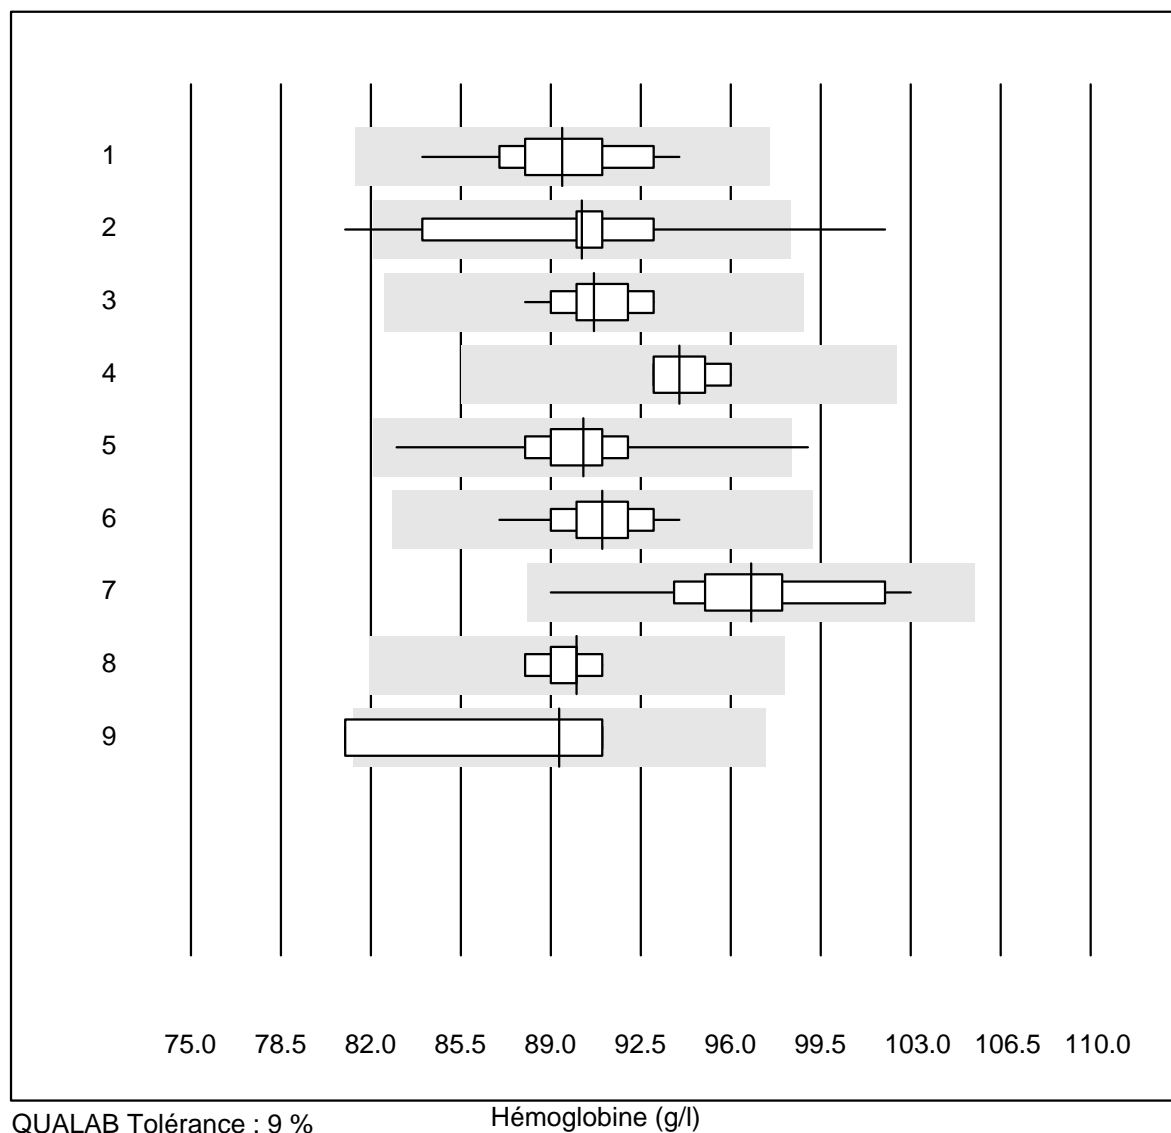


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Automate	16	100.0	0.0	0.0	89.4	2.7	e
2 Cyanmethémoglobine	19	89.5	10.5	0.0	90.2	4.4	e
3 Sysmex X	46	100.0	0.0	0.0	90.7	1.6	e
4 Advia 120	4	100.0	0.0	0.0	94.0	1.6	e
5 Hemocue	417	96.7	0.2	3.1	90.3	2.2	e
6 Hemocontrol	11	100.0	0.0	0.0	91.0	2.1	e
7 DiaSpect	15	100.0	0.0	0.0	96.8	3.5	e
8 Sysmex	9	100.0	0.0	0.0	90.0	1.1	e
9 Autres méthodes	4	50.0	25.0	25.0	89.3	5.9	a

Hémoglobine

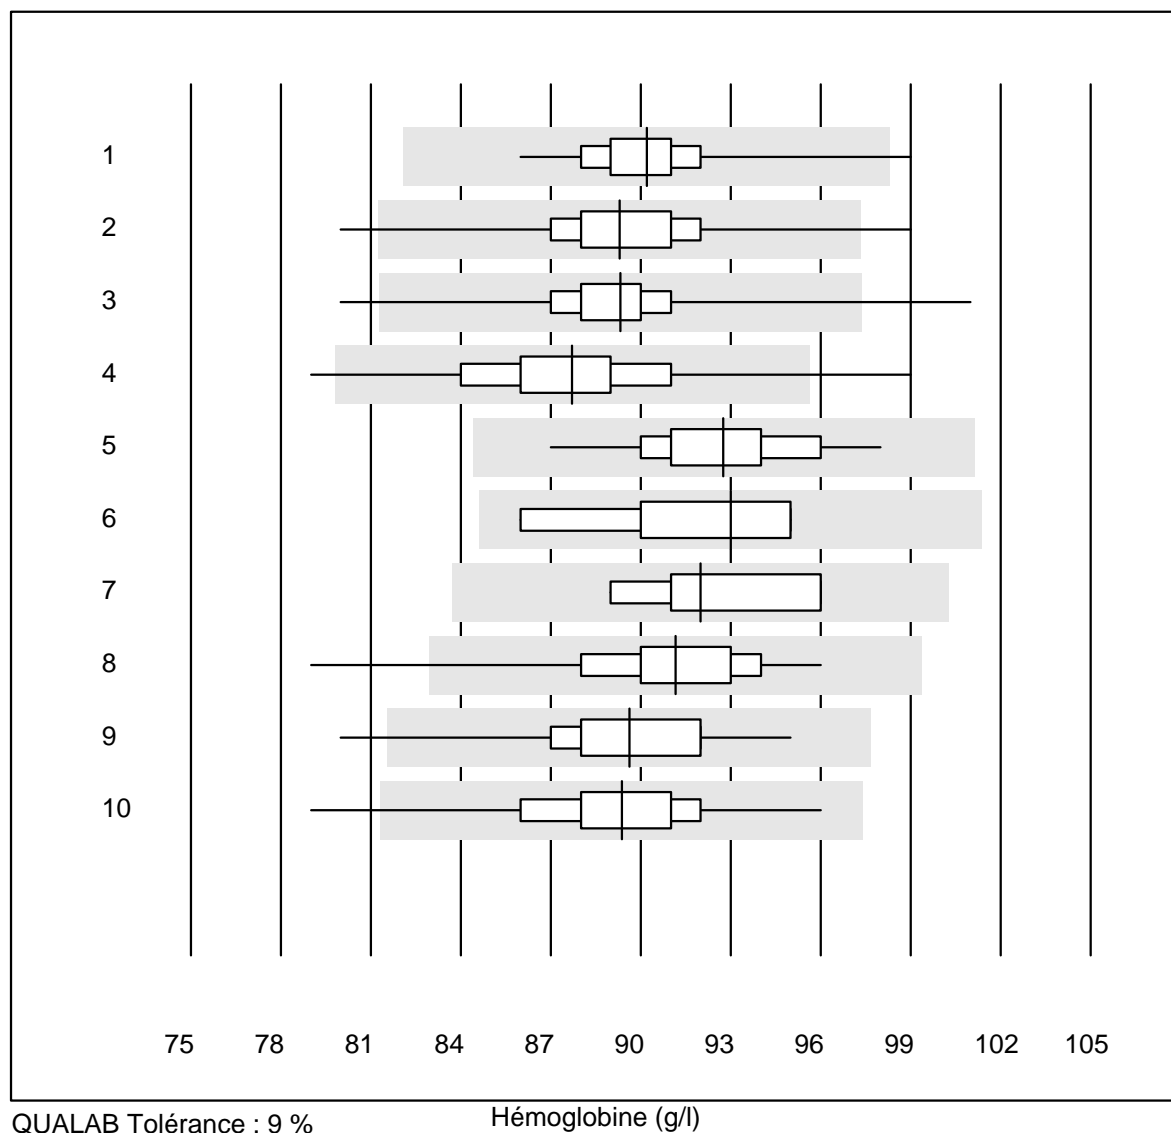

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex KX21	185	98.4	0.5	1.1	90.2	1.9	e
2 Sysmex PochH - 100i	198	94.0	2.5	3.5	89.3	2.7	e
3 Sysmex XP 300	627	97.6	0.6	1.8	89.3	1.9	e
4 Mythic	257	96.9	1.9	1.2	87.7	3.3	e
5 Swelab	29	100.0	0.0	0.0	92.8	2.6	e
6 Abacus Junior	5	100.0	0.0	0.0	93.0	4.2	e*
7 Medonic	6	100.0	0.0	0.0	92.0	3.0	e*
8 Celltac Alpha (Nihon)	85	95.2	2.4	2.4	91.2	2.9	e
9 Samsung HC10	21	95.2	4.8	0.0	89.6	3.6	e
10 Micros 60	95	96.8	1.1	2.1	89.4	2.8	e

Hématocrite

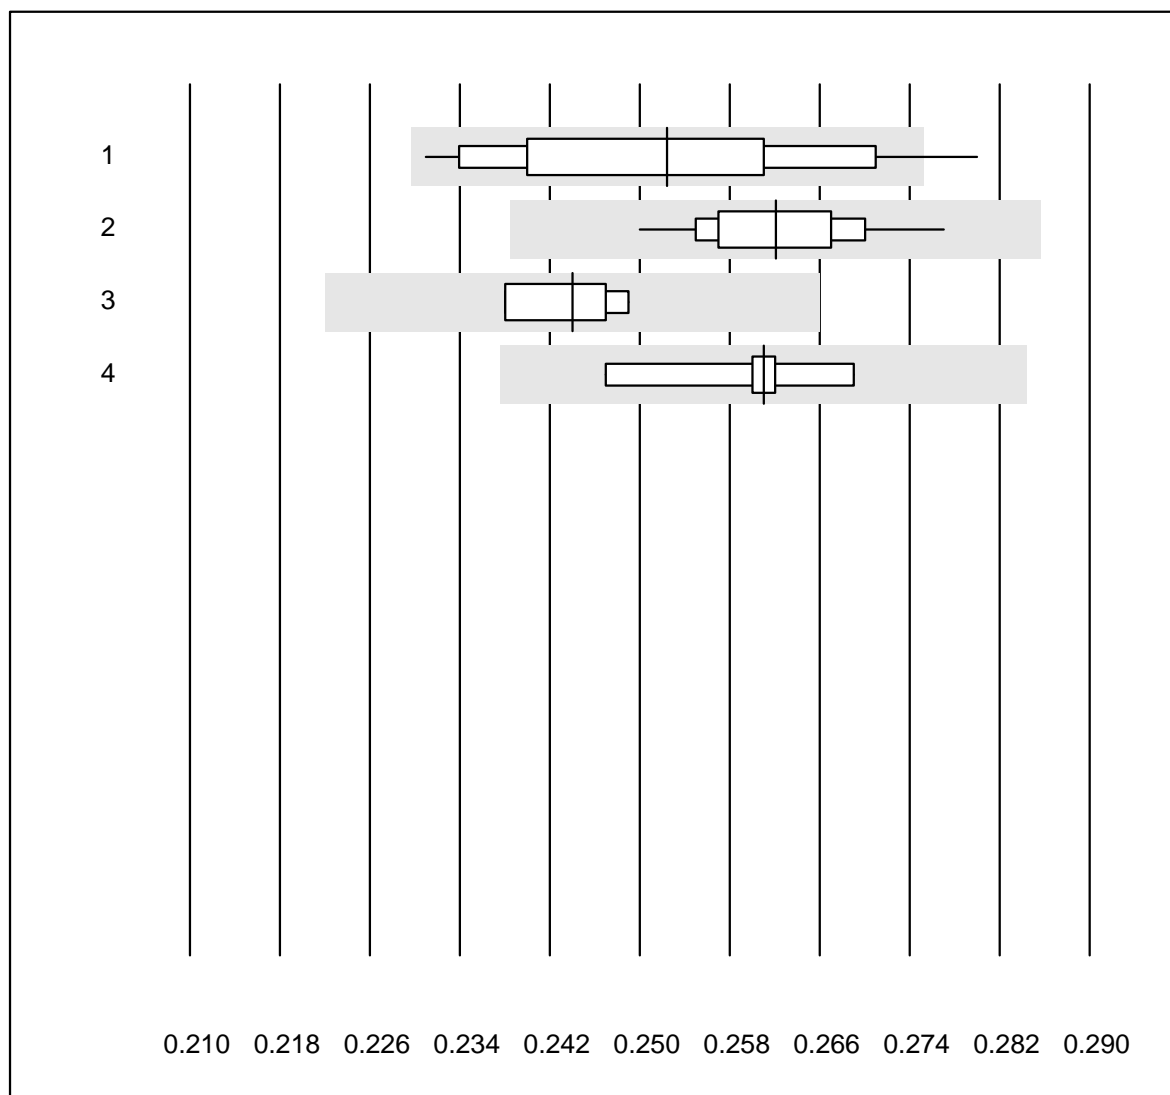


QUALAB Tolérance : 9 %

Hématocrite (l/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Automate	17	94.1	5.9	0.0	0.25	5.6	e*
2 Sysmex X	45	100.0	0.0	0.0	0.26	2.4	e
3 Advia 120	4	100.0	0.0	0.0	0.24	2.1	e
4 Sysmex	9	100.0	0.0	0.0	0.26	2.3	e

Hématocrite

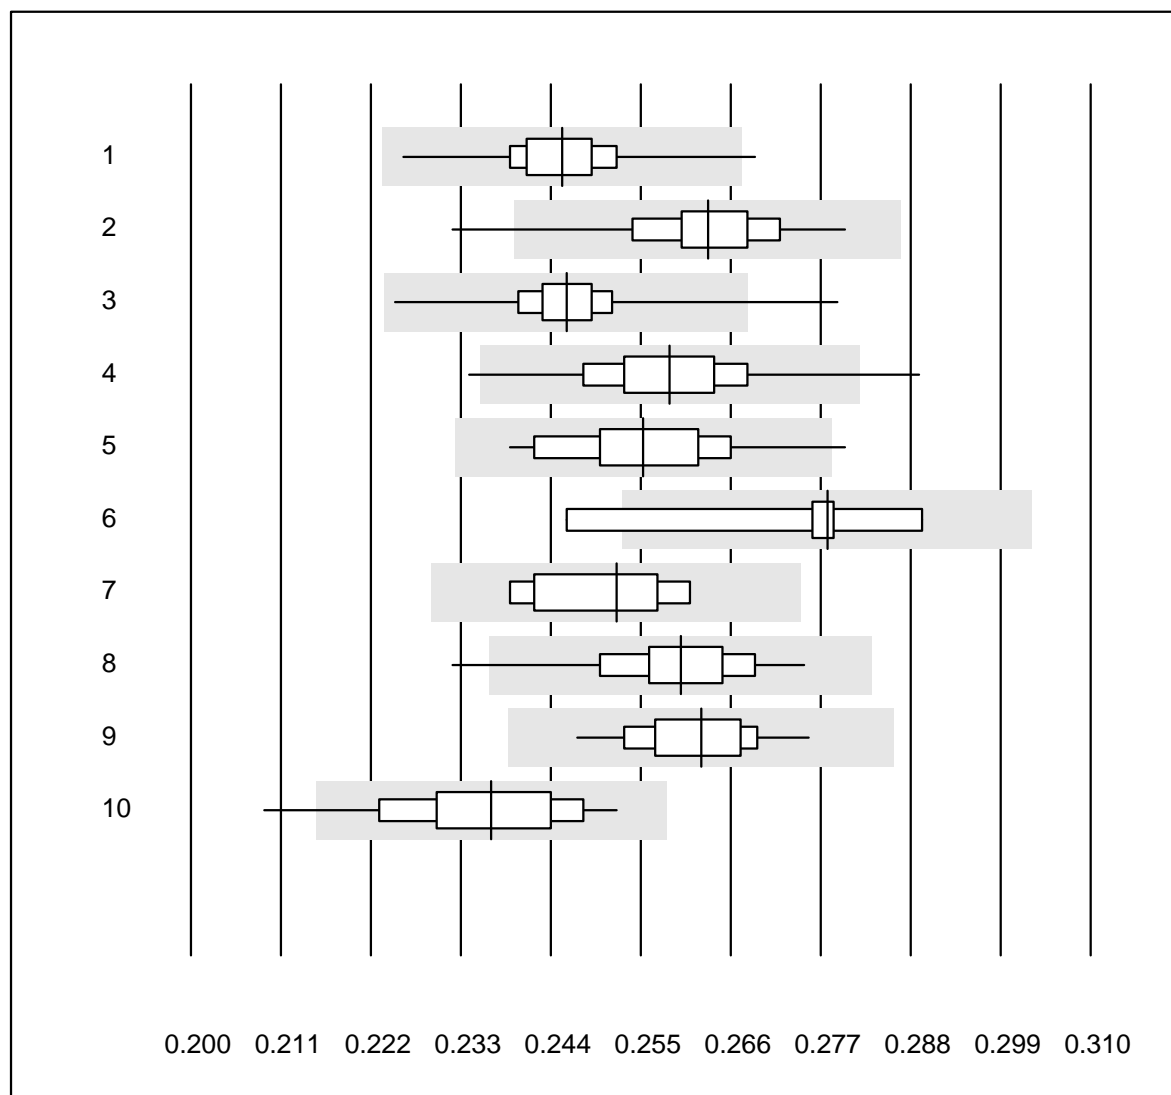


QUALAB Tolérance : 9 %

Hématocrite (l/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex KX21	185	97.9	0.5	1.6	0.25	2.2	e
2 Sysmex Poch - 100i	198	93.9	1.0	5.1	0.26	2.8	e
3 Sysmex XP 300	628	98.4	0.5	1.1	0.25	2.1	e
4 Mythic	258	96.5	0.8	2.7	0.26	3.2	e
5 Swelab	29	96.6	3.4	0.0	0.26	3.7	e
6 Abacus Junior	5	80.0	20.0	0.0	0.28	6.0	e*
7 Medonic	6	100.0	0.0	0.0	0.25	3.6	e*
8 Celltac Alpha (Nihon	85	96.4	1.2	2.4	0.26	3.1	e
9 Samsung HC10	21	100.0	0.0	0.0	0.26	2.6	e
10 Micros 60	94	93.6	2.1	4.3	0.24	4.0	e

Erythrocytes

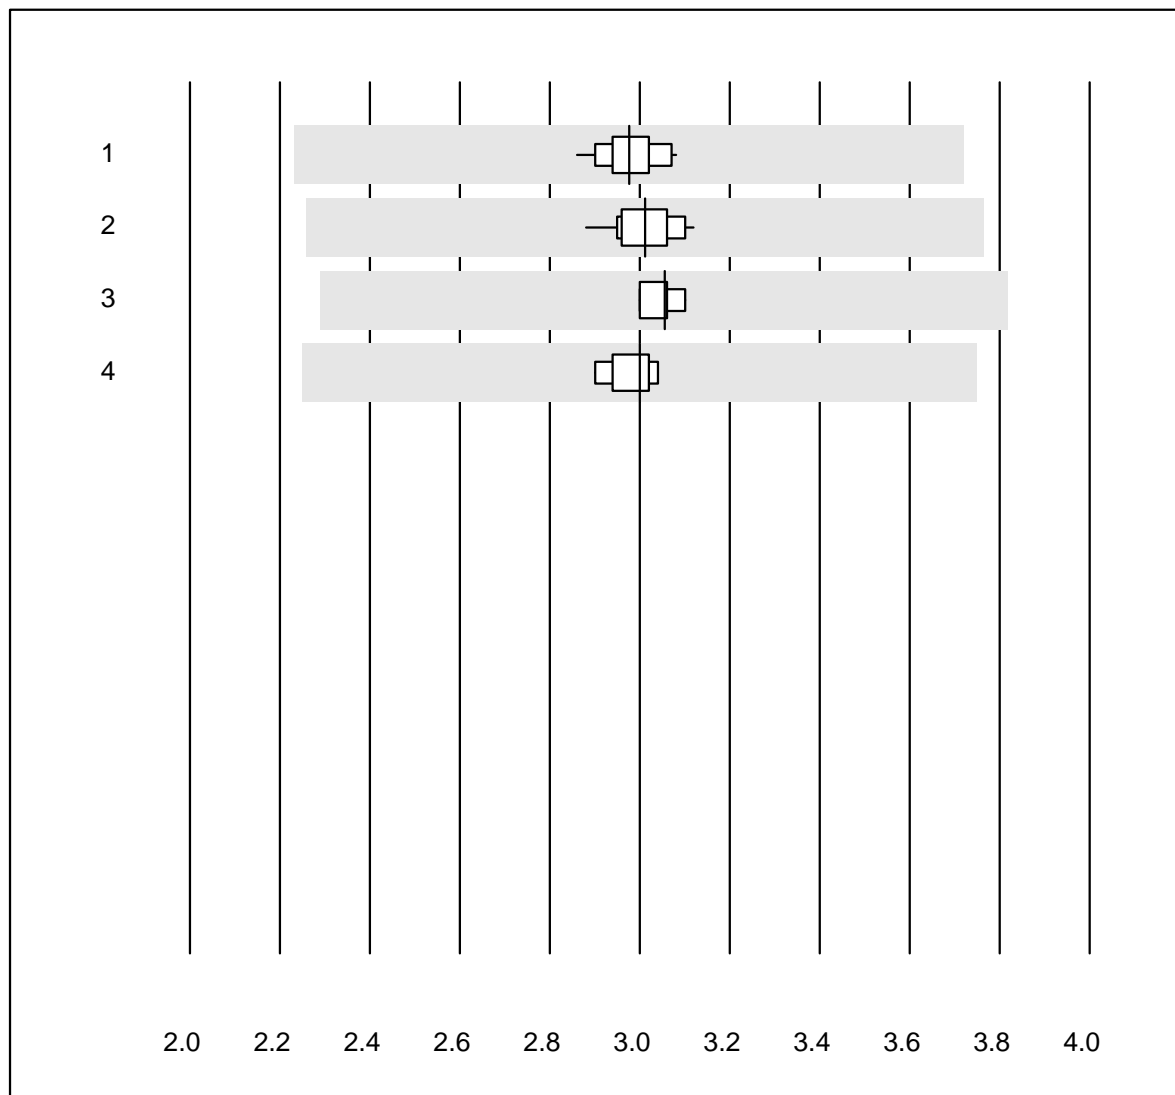


QUALAB Tolérance : 25 %

Erythrocytes (T/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Automate	15	100.0	0.0	0.0	2.98	2.1	e
2 Sysmex X	45	100.0	0.0	0.0	3.01	2.1	e
3 Advia 120	4	100.0	0.0	0.0	3.06	1.3	e
4 Sysmex	9	100.0	0.0	0.0	3.00	1.7	e

Erythrocytes

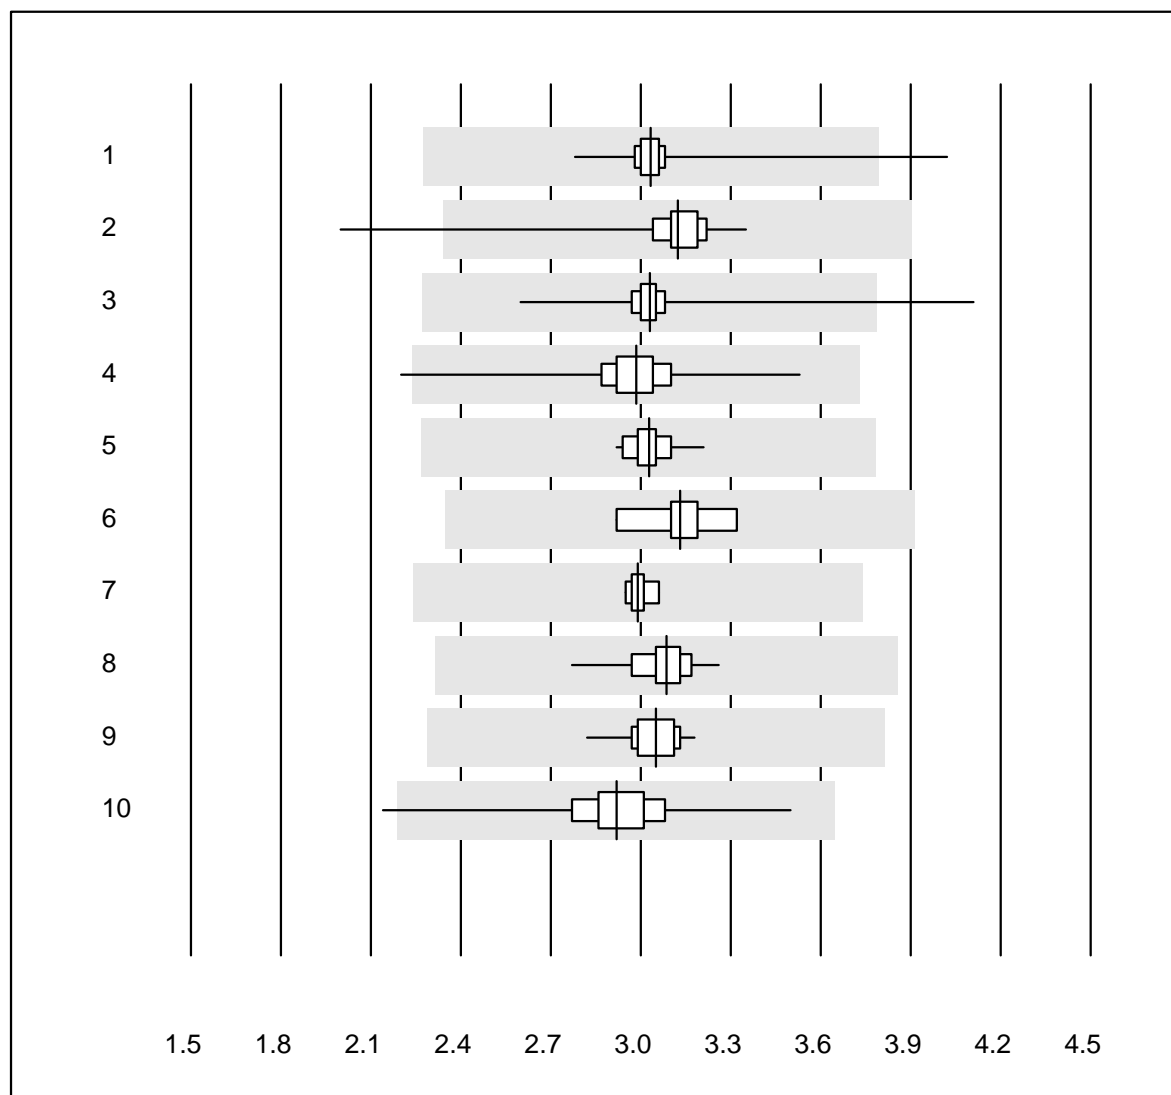


QUALAB Tolérance : 25 %

Erythrocytes (T/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	Sysmex KX21	185	99.0	0.5	0.5	3.03	2.9	e
2	Sysmex PochH - 100i	198	97.5	1.0	1.5	3.12	4.6	e
3	Sysmex XP 300	629	98.2	0.5	1.3	3.03	3.1	e
4	Mythic	258	98.8	0.4	0.8	2.98	4.0	e
5	Swelab	29	96.6	0.0	3.4	3.03	2.0	e
6	Abacus Junior	5	100.0	0.0	0.0	3.13	4.6	e
7	Medonic	6	100.0	0.0	0.0	2.99	1.3	e
8	Celltac Alpha (Nihon	85	97.6	0.0	2.4	3.09	2.8	e
9	Samsung HC10	21	95.2	0.0	4.8	3.05	2.7	e
10	Micros 60	95	97.8	1.1	1.1	2.92	5.8	e

Leucocytes

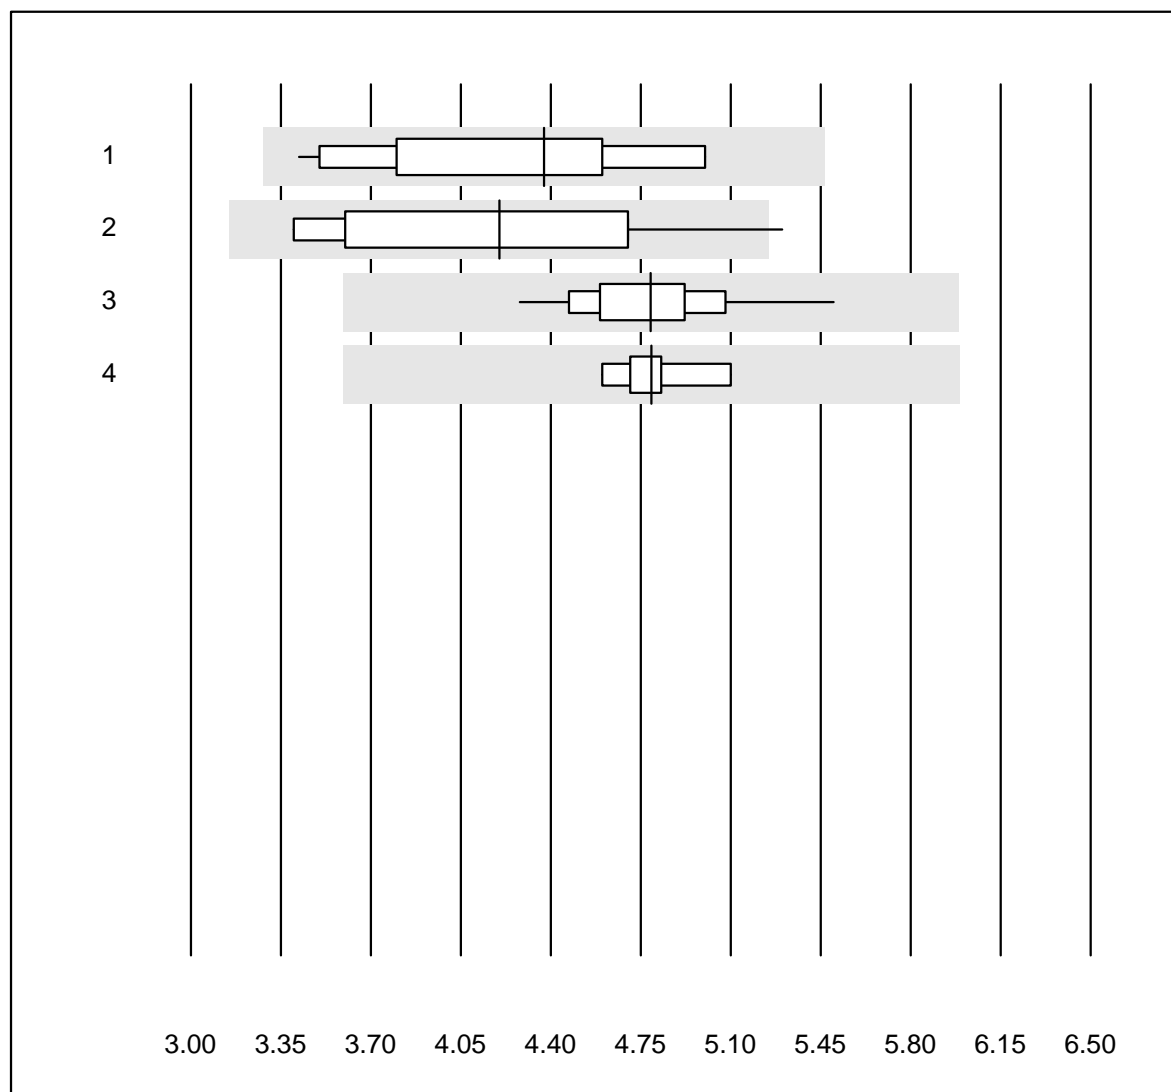


QUALAB Tolérance : 25 %

Leucocytes (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Automate	16	100.0	0.0	0.0	4.37	12.0	a
2 Microscopie	11	81.8	9.1	9.1	4.20	14.8	e*
3 Sysmex X	45	100.0	0.0	0.0	4.79	5.2	e
4 Sysmex	9	100.0	0.0	0.0	4.79	3.4	e

Leucocytes

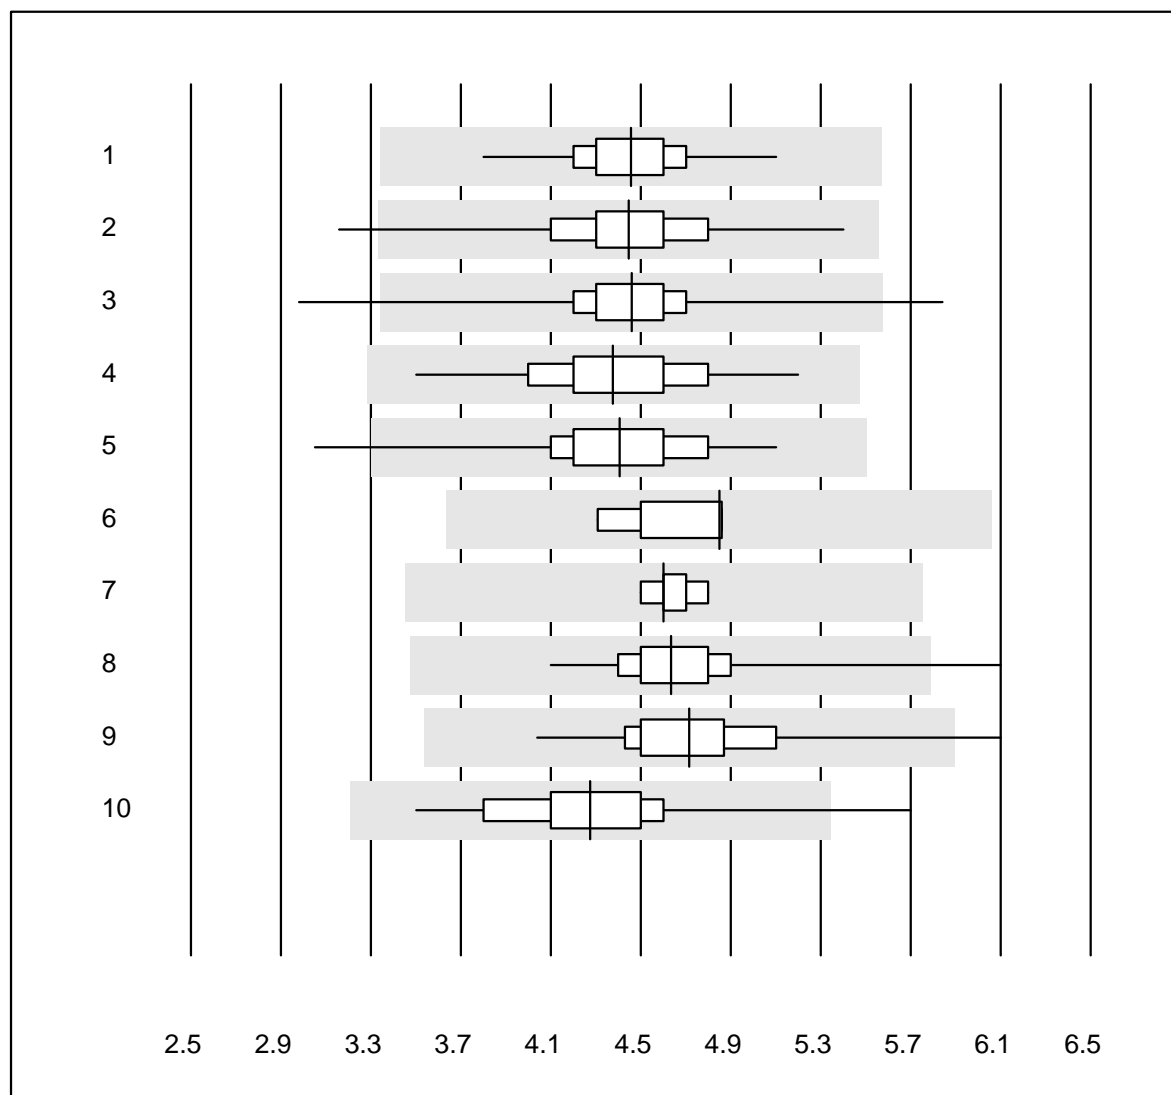


QUALAB Tolérance : 25 %

Leucocytes (G/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	Sysmex KX21	184	100.0	0.0	0.0	4.46	5.4	e
2	Sysmex PochH - 100i	198	98.0	0.5	1.5	4.45	6.6	e
3	Sysmex XP 300	629	98.6	0.6	0.8	4.46	5.6	e
4	Mythic	256	99.6	0.0	0.4	4.38	6.6	e
5	Swelab	29	96.6	3.4	0.0	4.41	8.4	e
6	Abacus Junior	5	100.0	0.0	0.0	4.85	5.5	e
7	Medonic	5	100.0	0.0	0.0	4.60	2.5	e
8	Celltac Alpha (Nihon	85	95.3	1.2	3.5	4.63	5.5	e
9	Samsung HC10	21	95.2	4.8	0.0	4.72	9.1	e
10	Micros 60	95	97.8	1.1	1.1	4.28	7.8	e

Thrombocytes

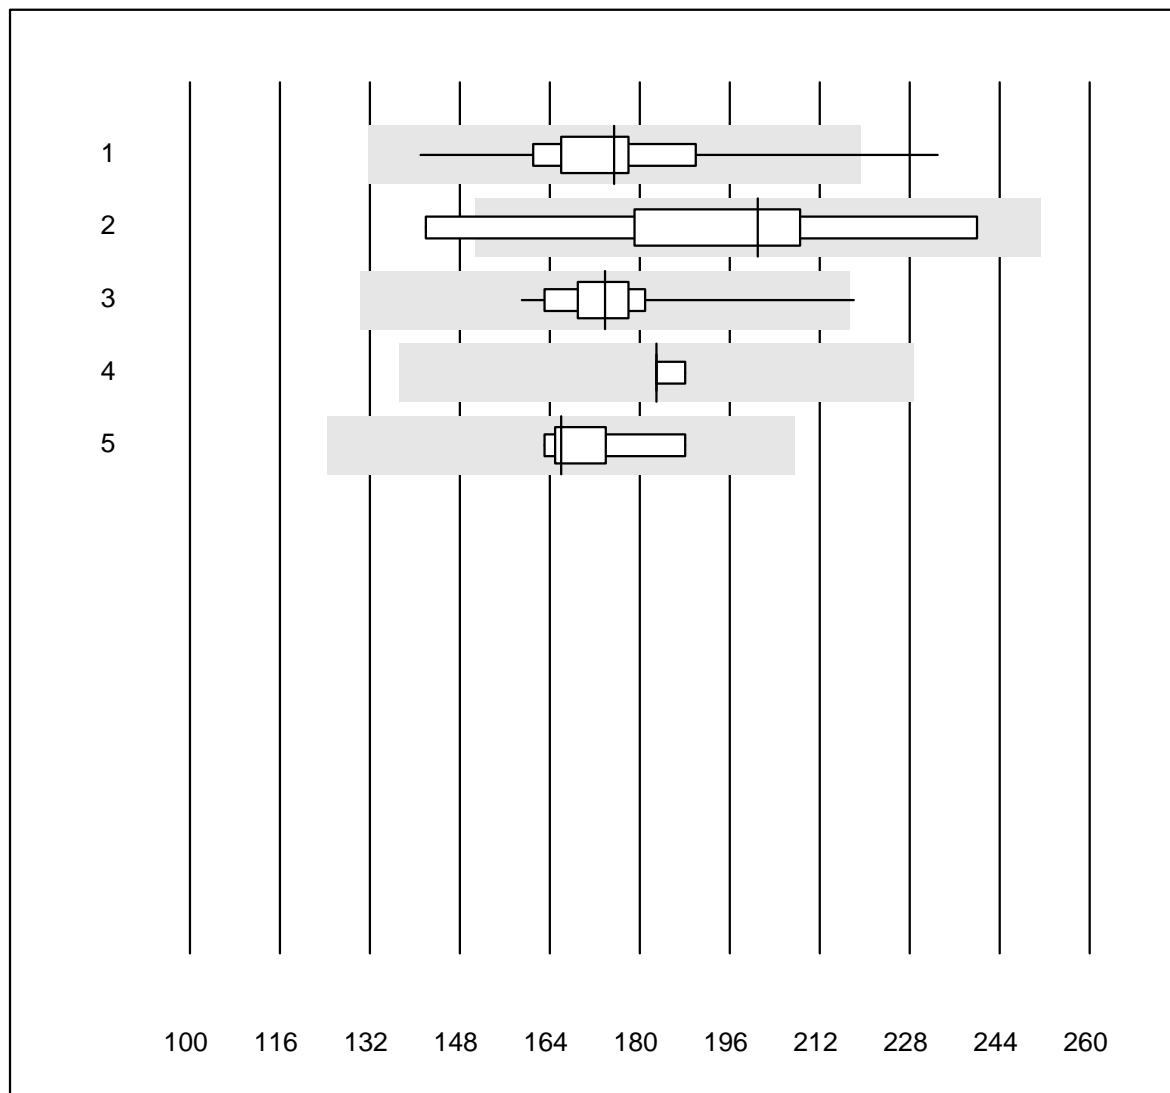


QUALAB Tolérance : 25 %

Thrombocytes (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Automate	14	85.8	7.1	7.1	175.5	11.9	e*
2 Microscopie	6	83.3	16.7	0.0	201.0	16.7	e*
3 Sysmex X	45	95.6	2.2	2.2	173.9	5.5	e
4 Advia 120	4	100.0	0.0	0.0	183.0	1.4	e
5 Sysmex	9	88.9	0.0	11.1	166.0	5.3	e

Thrombocytes

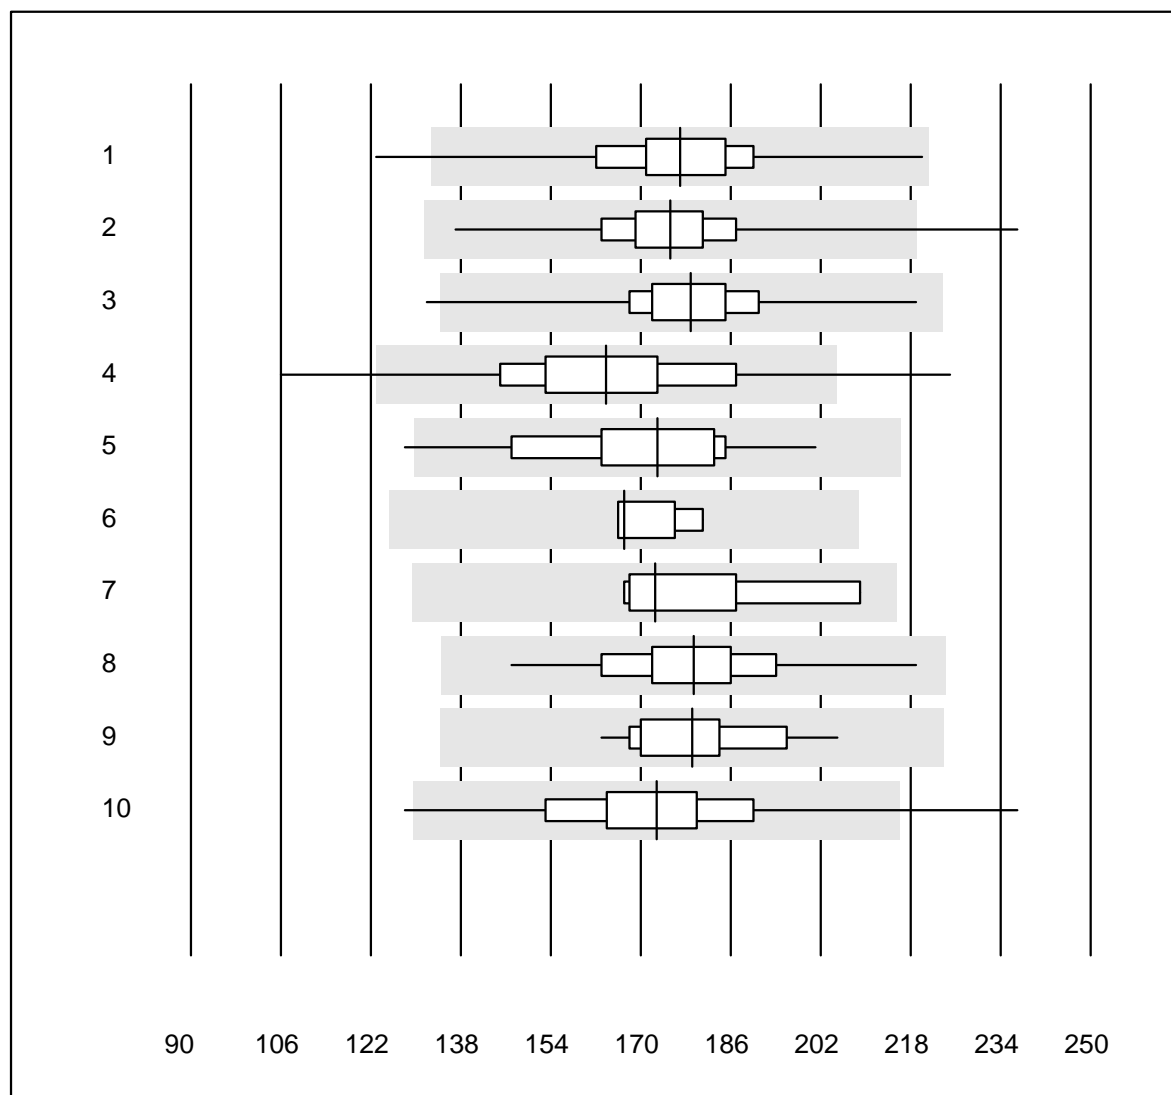


QUALAB Tolérance : 25 %

Thrombocytes (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex KX21	184	99.0	0.5	0.5	177.0	6.8	e
2 Sysmex Poch - 100i	197	99.0	1.0	0.0	175.2	6.8	e
3 Sysmex XP 300	629	99.0	0.2	0.8	178.9	5.5	e
4 Mythic	258	96.1	3.5	0.4	163.9	10.8	e
5 Swelab	29	96.6	3.4	0.0	173.0	9.2	e
6 Abacus Junior	5	100.0	0.0	0.0	167.0	4.0	e
7 Medonic	6	100.0	0.0	0.0	172.5	9.1	e*
8 Celltac Alpha (Nihon)	85	97.6	0.0	2.4	179.4	7.1	e
9 Samsung HC10	21	100.0	0.0	0.0	179.1	6.3	e
10 Micros 60	95	93.6	3.2	3.2	172.8	9.7	e

Hémoglobine H2

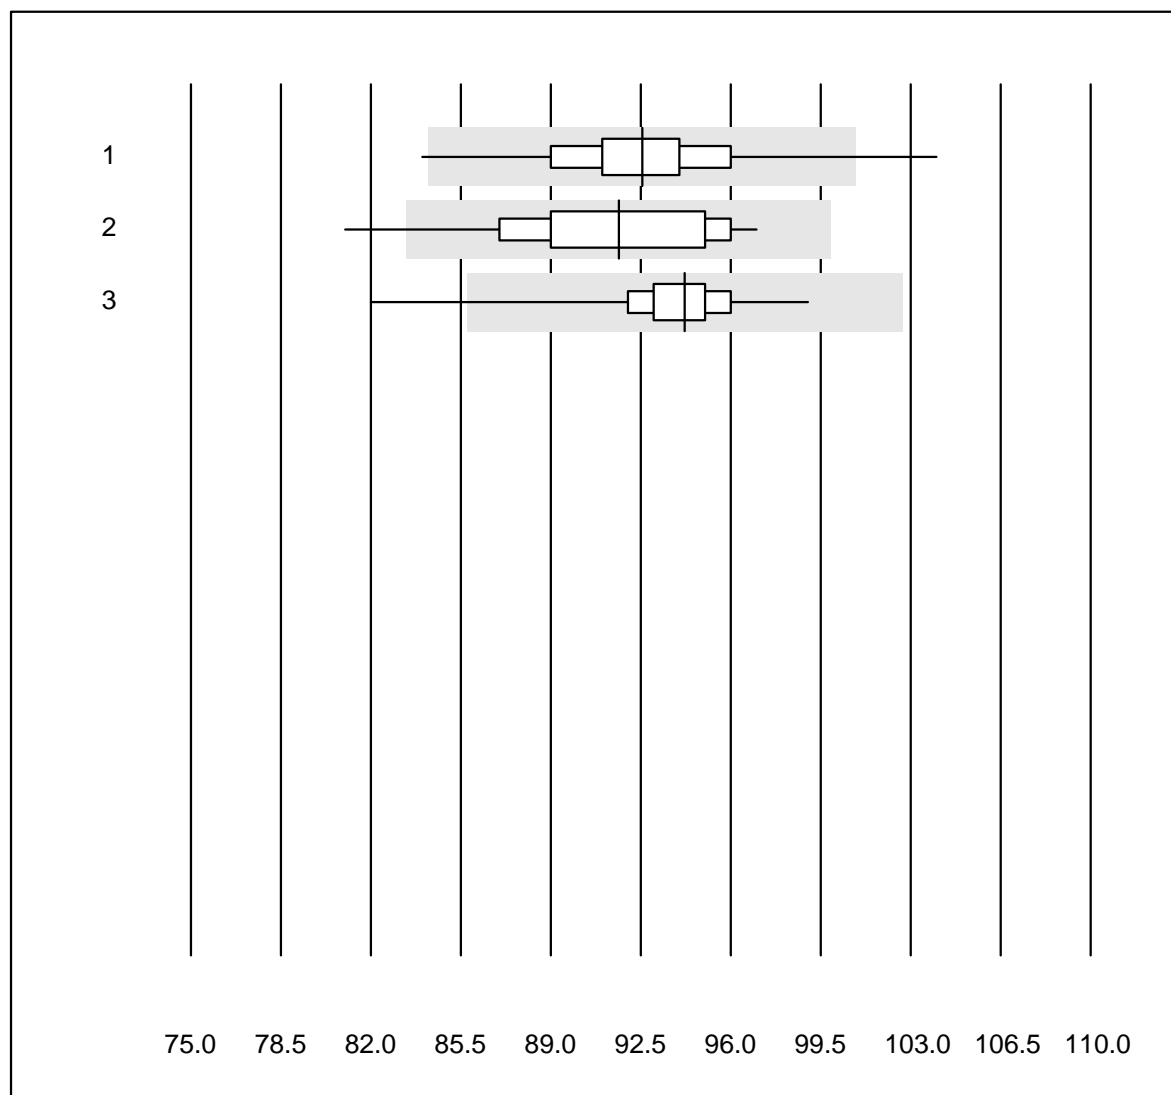


QUALAB Tolérance : 9 %

Hémoglobine H2 (g/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Z3	145	95.2	1.4	3.4	92.6	2.8	e
2 Abx Micros	77	96.1	1.3	2.6	91.6	3.7	e
3 Microsemi	858	95.2	1.3	3.5	94.2	2.4	e

Hématocrite H2

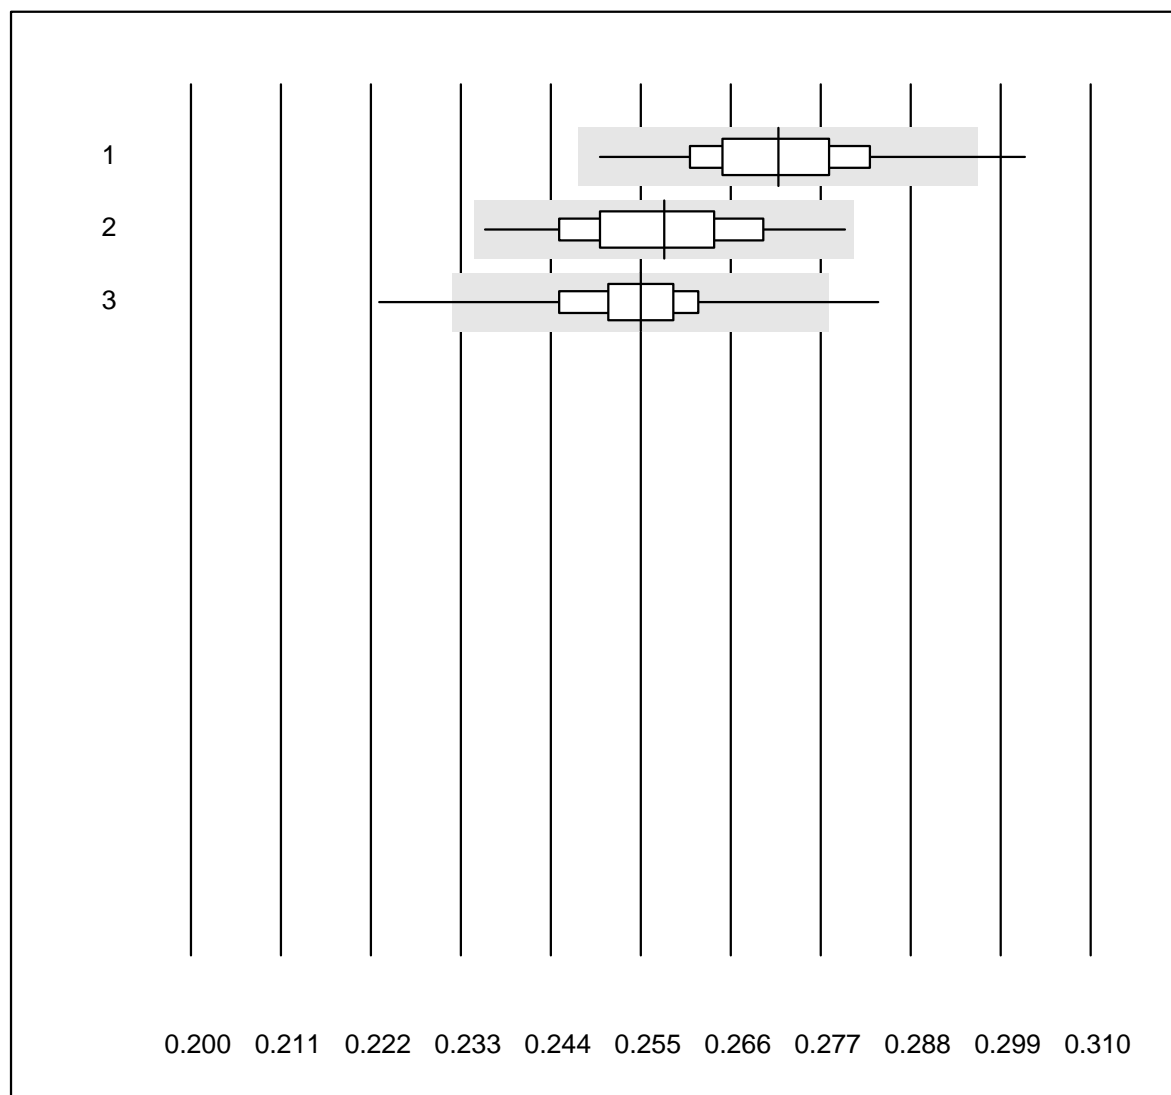


QUALAB Tolérance : 9 %

Hématocrite H2 (l/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Z3	145	95.2	0.7	4.1	0.27	3.5	e
2 Abx Micros	77	96.1	0.0	3.9	0.26	3.8	e
3 Microsemi	857	95.0	1.4	3.6	0.26	2.9	e

Leucocytes H2

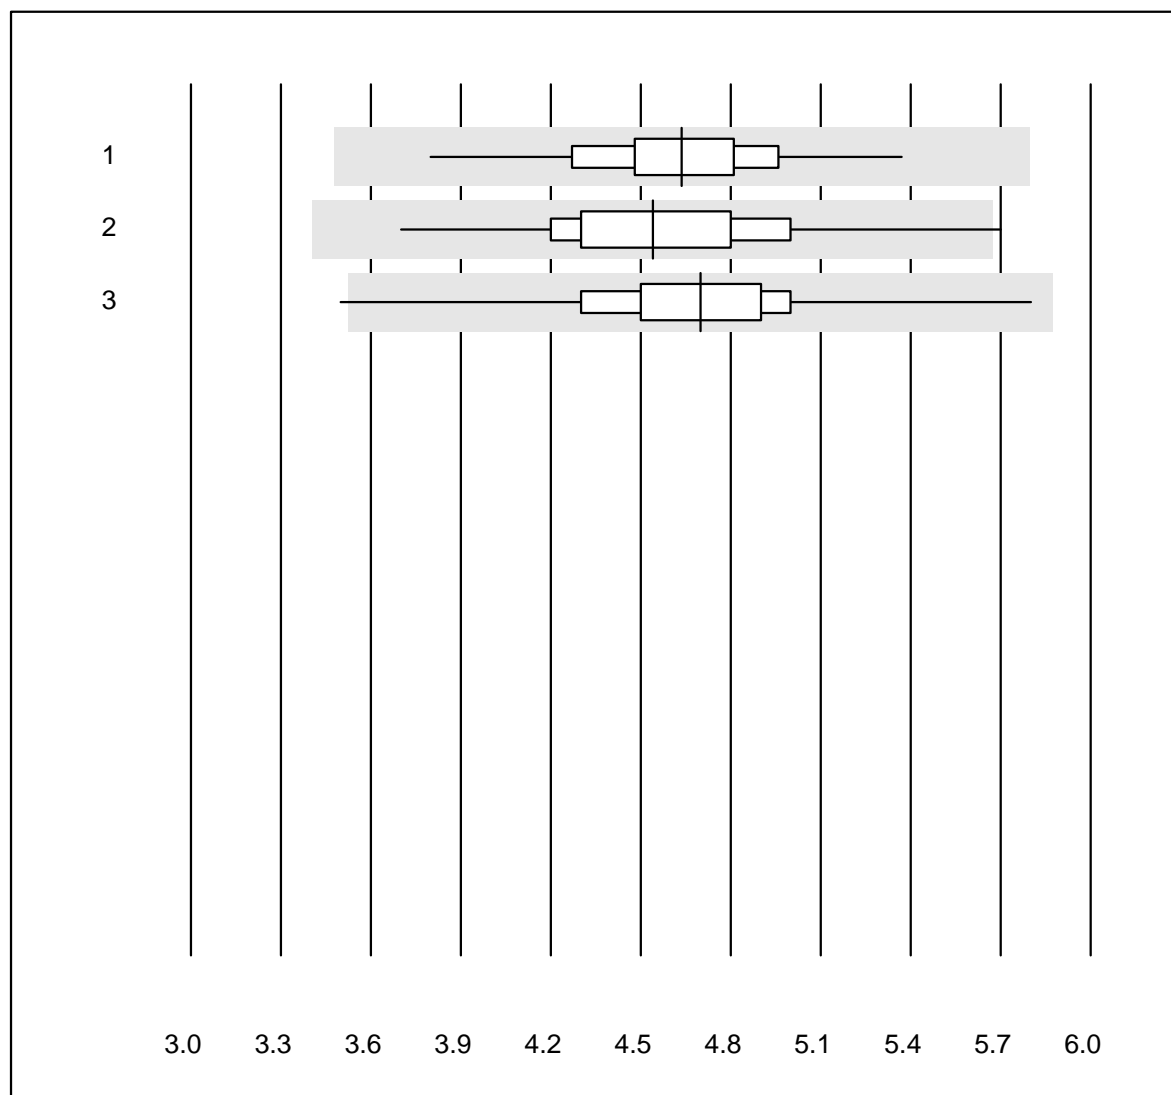


QUALAB Tolérance : 25 %

Leucocytes H2 (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Z3	145	96.6	0.0	3.4	4.64	5.9	e
2 Abx Micros	77	96.1	1.3	2.6	4.54	7.6	e
3 Microsemi	858	98.4	0.6	1.0	4.70	6.6	e

Thrombocytes H2

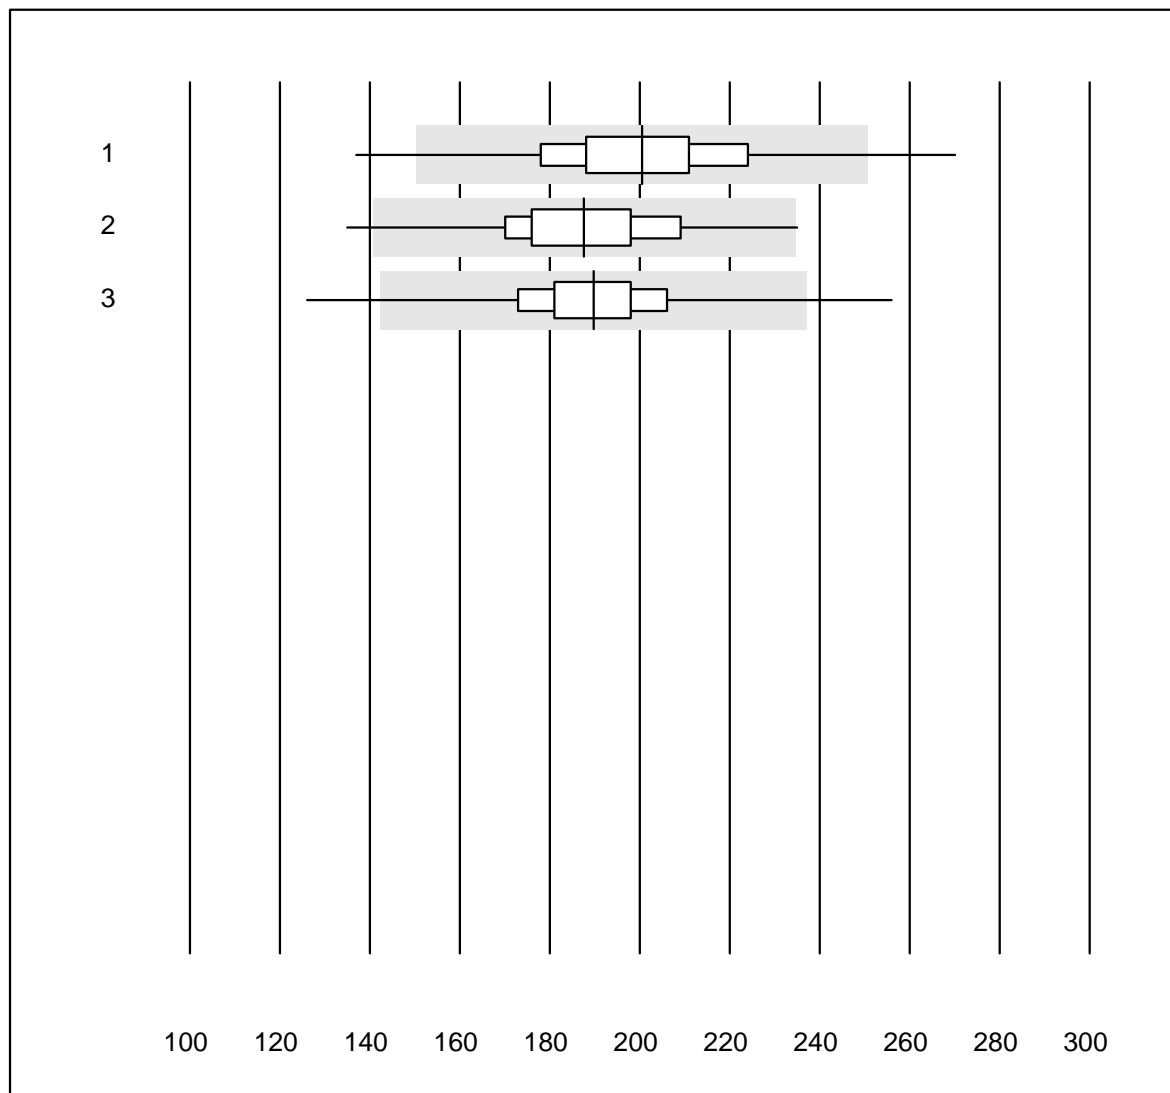


QUALAB Tolérance : 25 %

Thrombocytes H2 (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Z3	145	95.9	3.4	0.7	200.5	9.9	e
2 Abx Micros	77	90.9	2.6	6.5	187.6	9.4	e
3 Microsemi	858	97.0	1.3	1.7	189.7	7.6	e

Erythrocytes H2

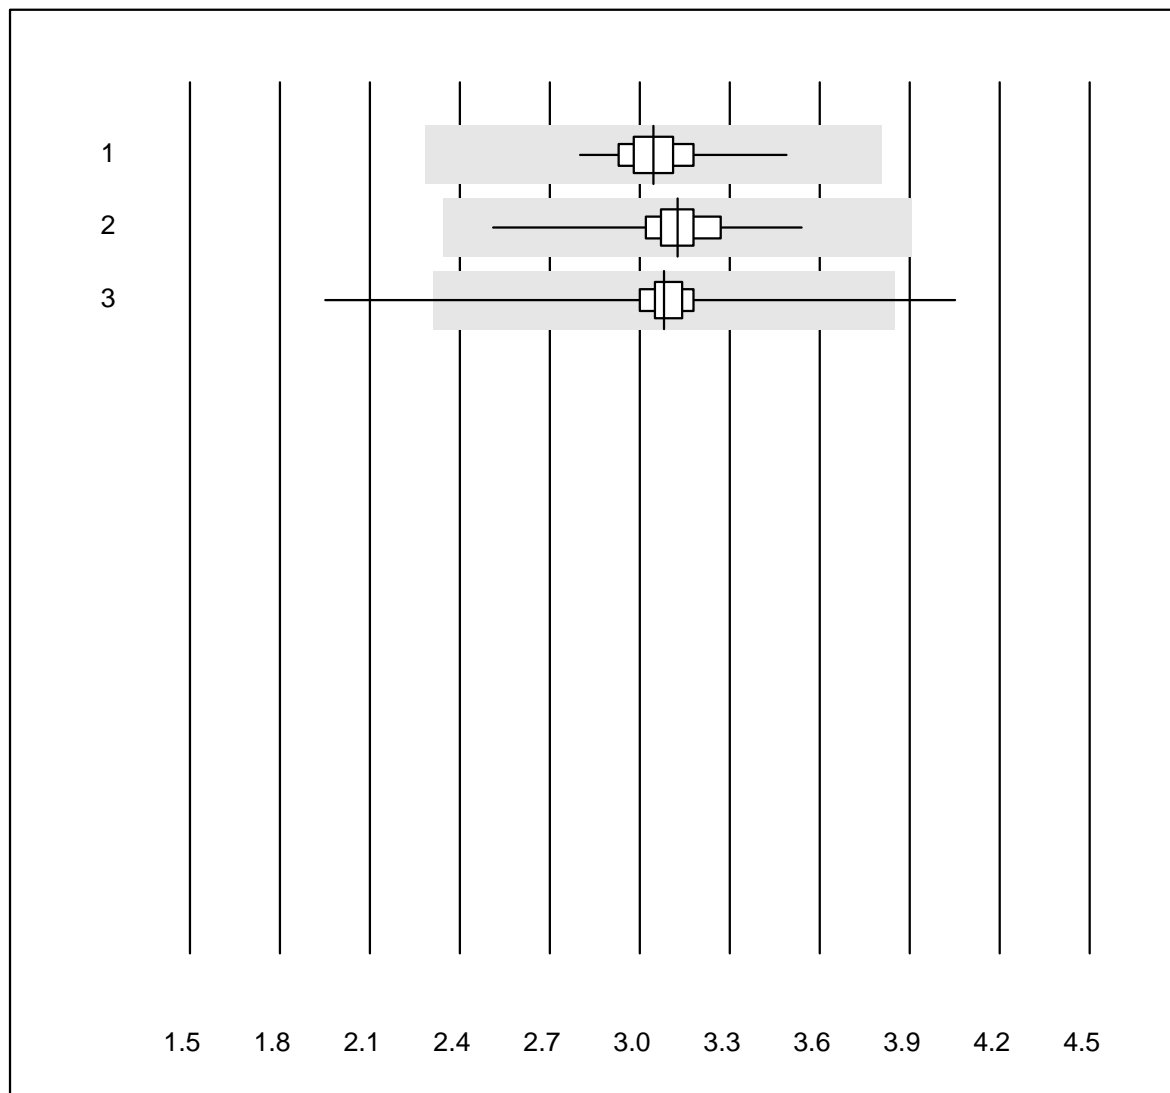


QUALAB Tolérance : 25 %

Erythrocytes H2 (T/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Z3	145	97.2	0.0	2.8	3.05	3.6	e
2 Abx Micros	77	98.7	0.0	1.3	3.13	4.0	e
3 Microsemi	858	96.8	1.3	1.9	3.08	4.8	e

CRP H2

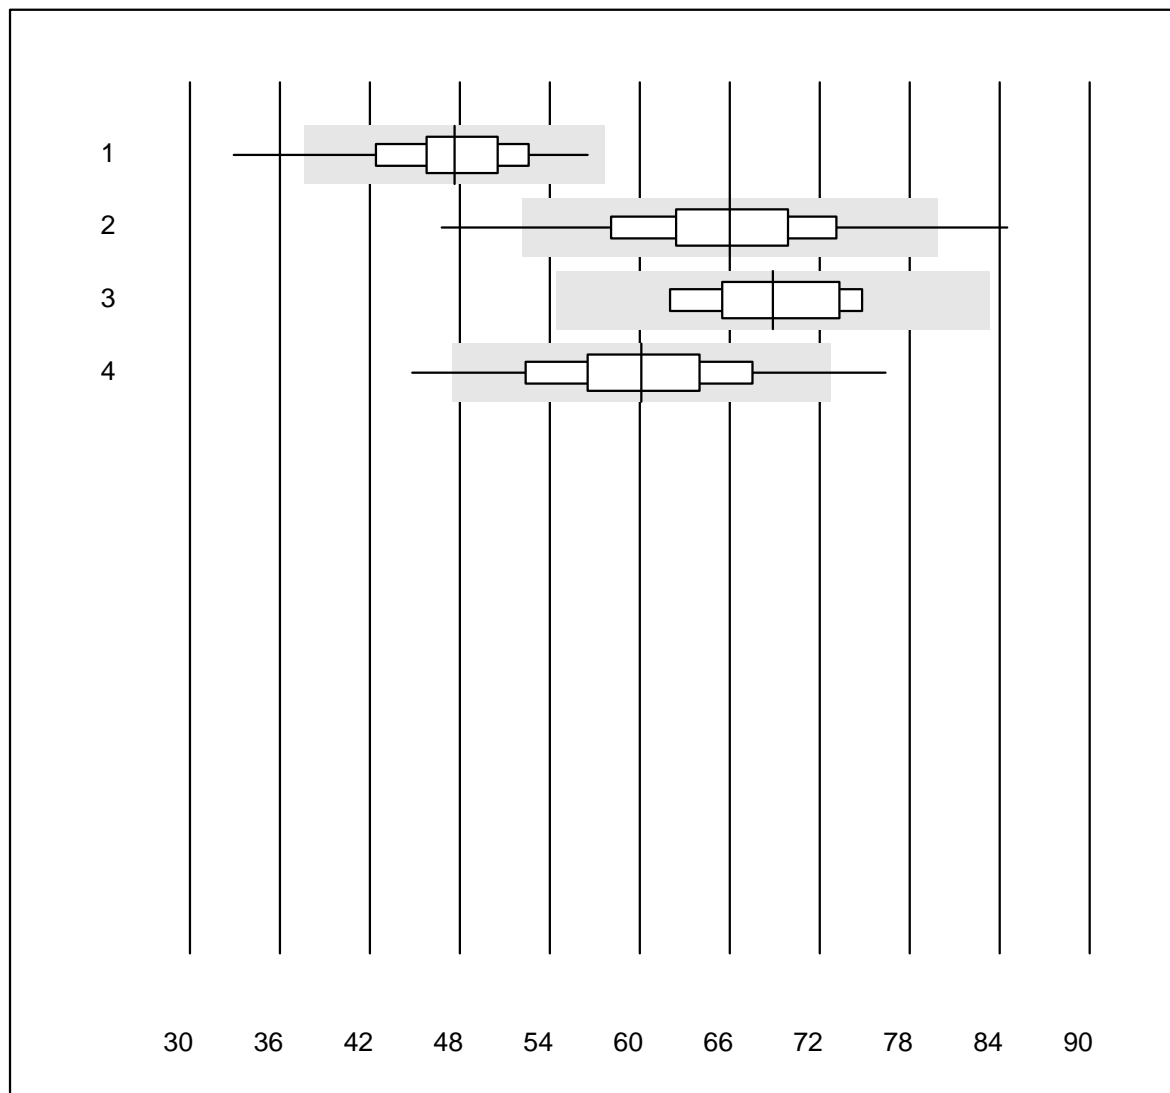


QUALAB Tolérance : 21 %

CRP H2 (mg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Z3	133	93.2	2.3	4.5	47.7	8.7	e
2 Microsemi	844	92.6	3.4	4.0	66.0	9.2	e
3 Abx Micros	8	87.5	0.0	12.5	68.9	6.4	e
4 ABX Micros CRP200	69	91.4	4.3	4.3	60.1	10.0	e

Hémoglobine BG

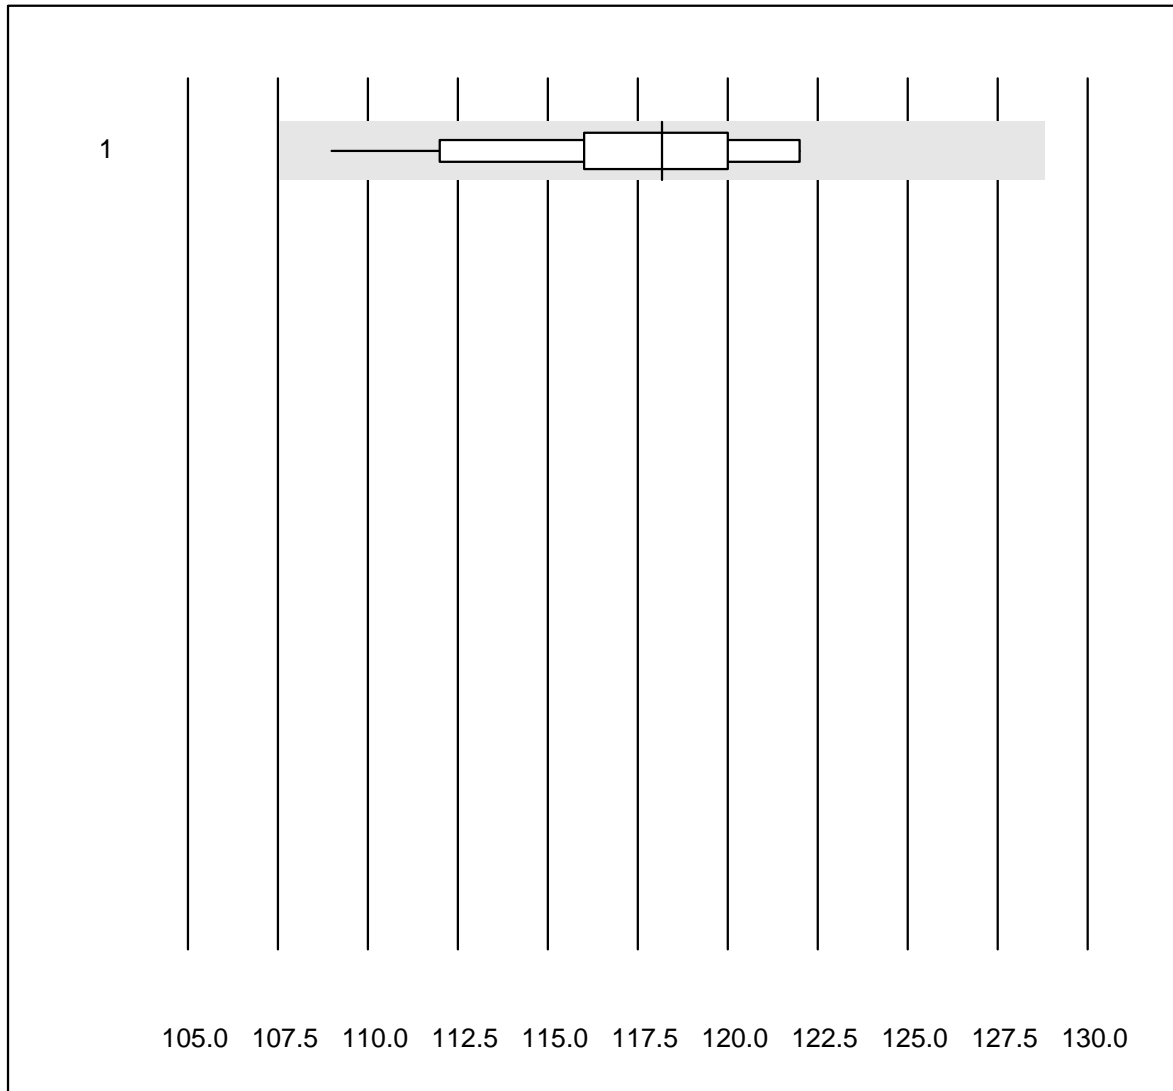


QUALAB Tolérance : 9 %

Hémoglobine BG (g/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 iStat	13	92.3	0.0	7.7	118.2	3.4	e

Hématocrite

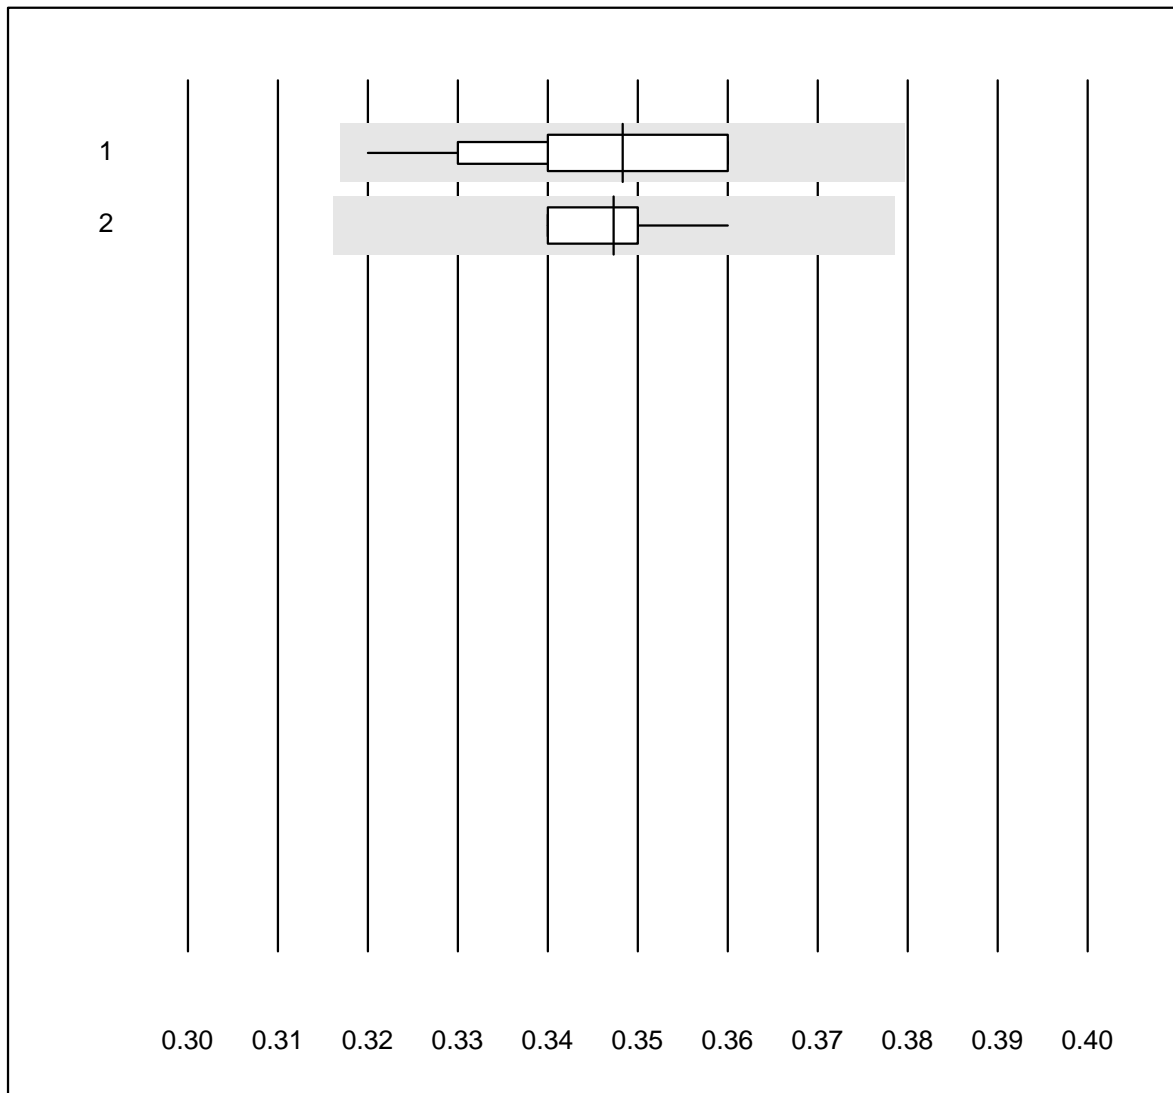


QUALAB Tolérance : 9 %

Hématocrite (l/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 iStat	19	94.7	0.0	5.3	0.35	3.4	e
2 EPOC	11	100.0	0.0	0.0	0.35	1.9	e

Hémoglobine

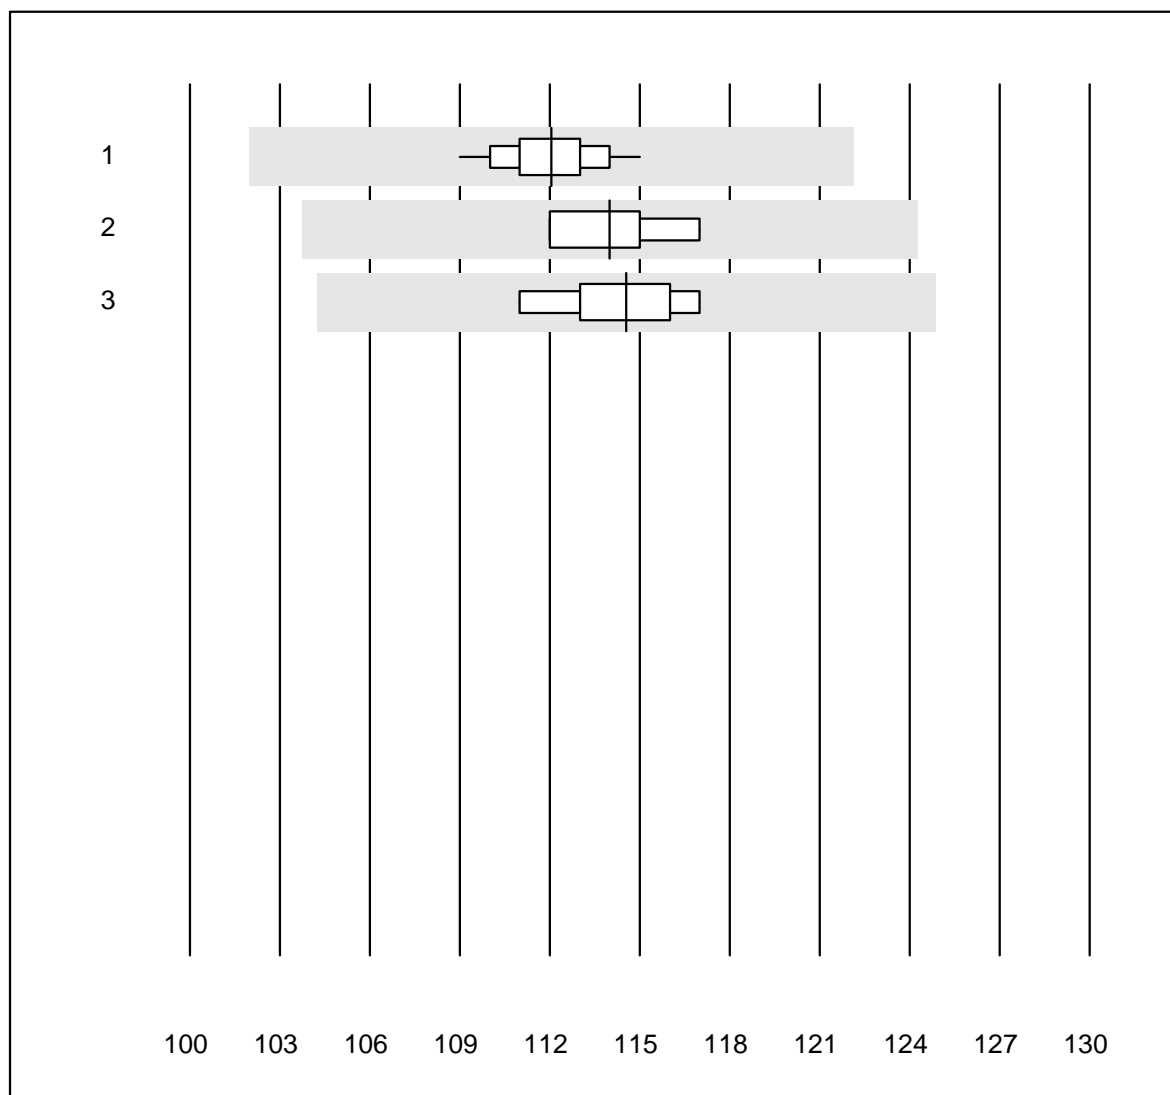


QUALAB Tolérance : 9 %

Hémoglobine (g/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	91	100.0	0.0	0.0	112.1	1.2	e
2 Advia	5	100.0	0.0	0.0	114.0	1.9	e
3 Yumizen/Pentra	14	92.9	0.0	7.1	114.5	1.8	e

Hématocrite

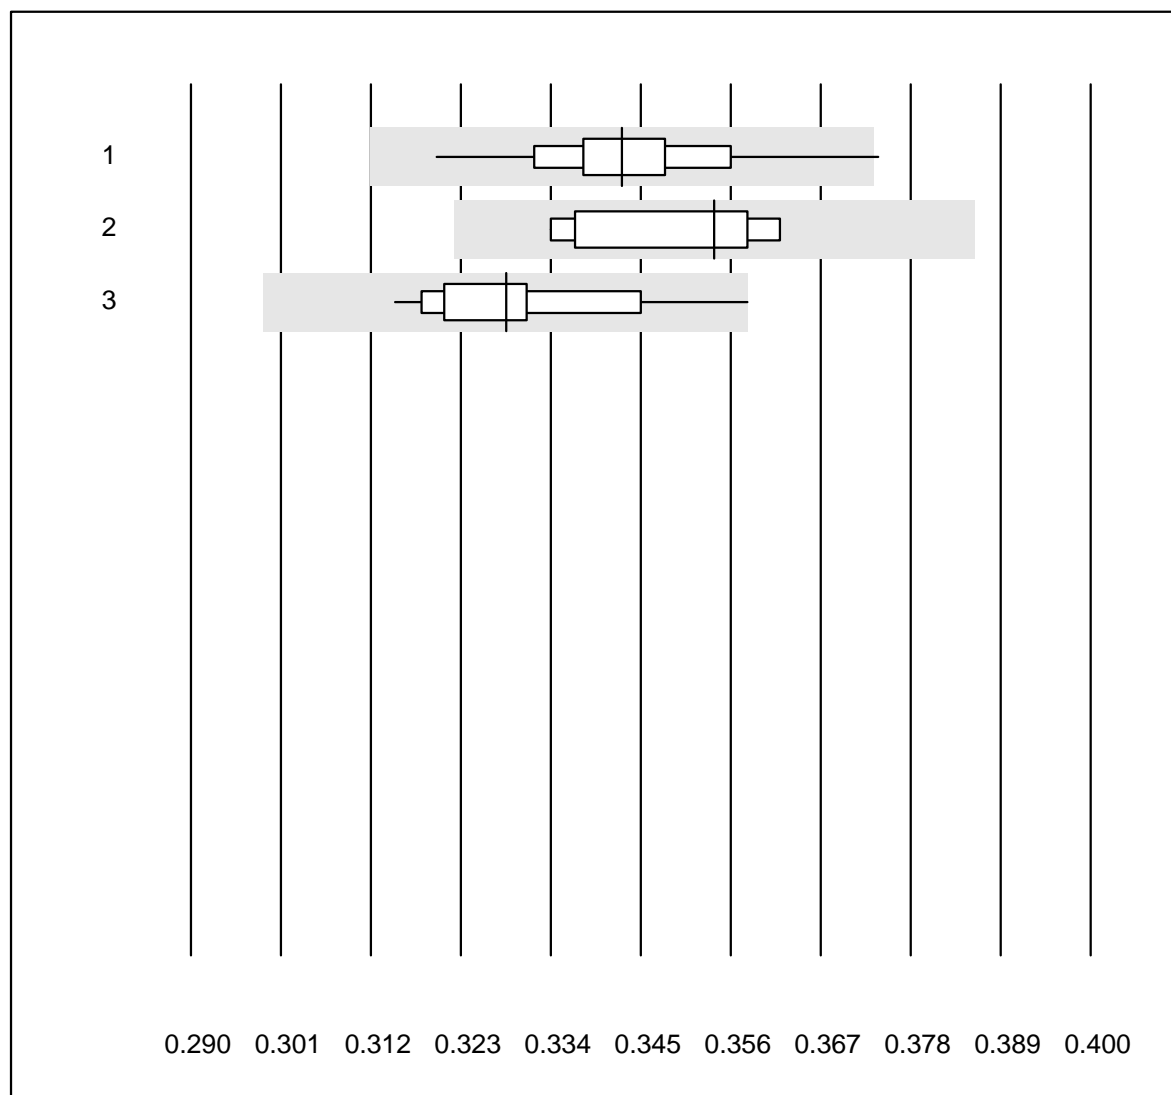


QUALAB Tolérance : 9 %

Hématocrite (l/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	93	98.9	1.1	0.0	0.34	2.6	e
2 Advia	5	100.0	0.0	0.0	0.35	3.6	e*
3 Yumizen/Pentra	14	92.9	0.0	7.1	0.33	3.7	e

Erythrocytes

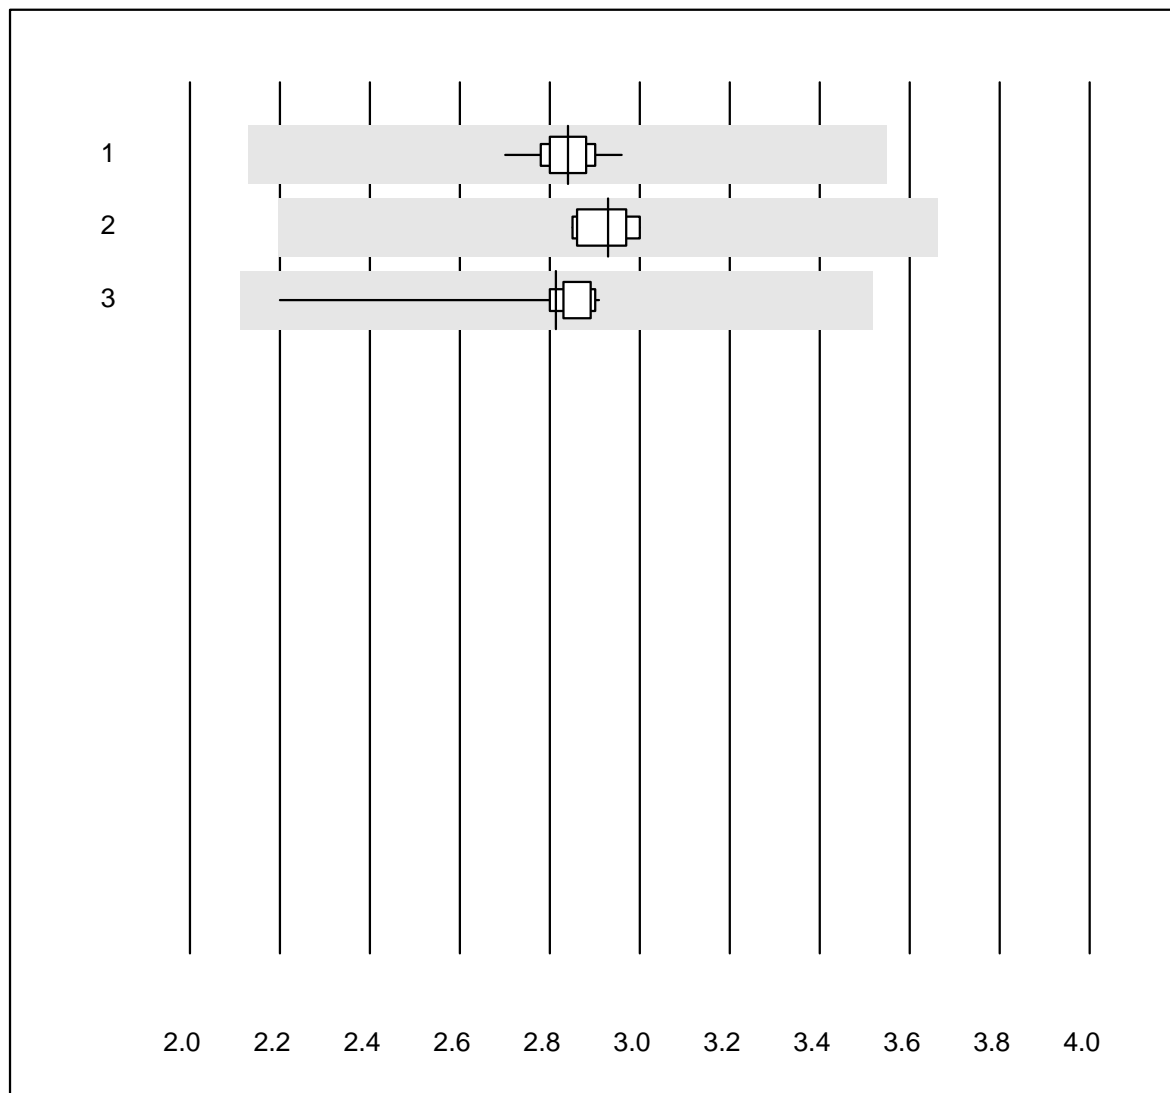


QUALAB Tolérance : 25 %

Erythrocytes (T/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	93	100.0	0.0	0.0	2.84	1.8	e
2 Advia	5	100.0	0.0	0.0	2.93	2.3	e
3 Yumizen/Pentra	14	100.0	0.0	0.0	2.81	6.4	e

Leucocytes

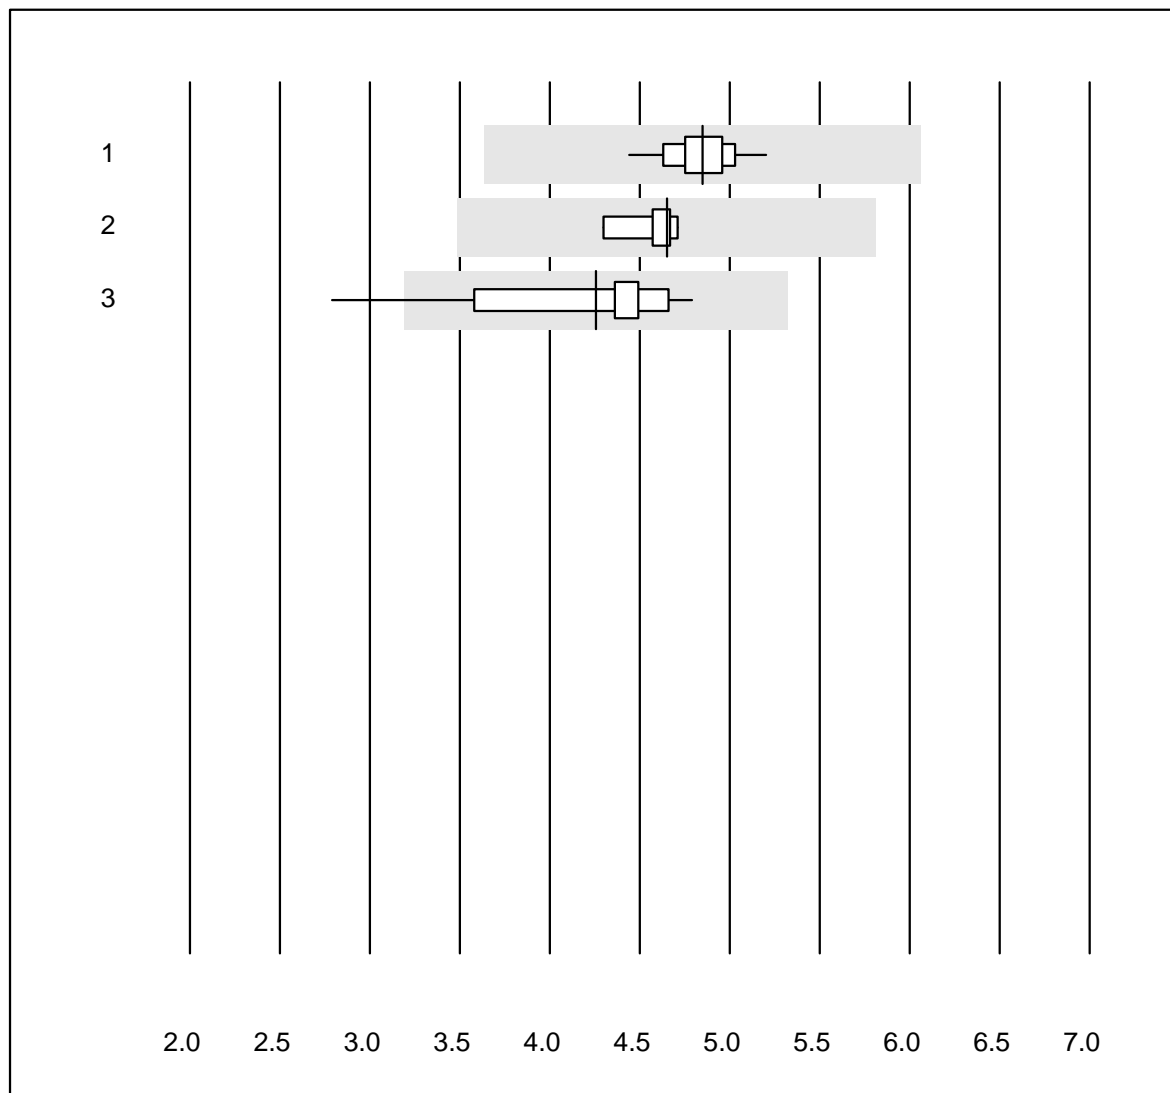


QUALAB Tolérance : 25 %

Leucocytes (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	92	100.0	0.0	0.0	4.85	3.4	e
2 Advia	5	100.0	0.0	0.0	4.65	3.6	e
3 Yumizen/Pentra	14	85.8	7.1	7.1	4.26	12.4	e*

Thrombocytes

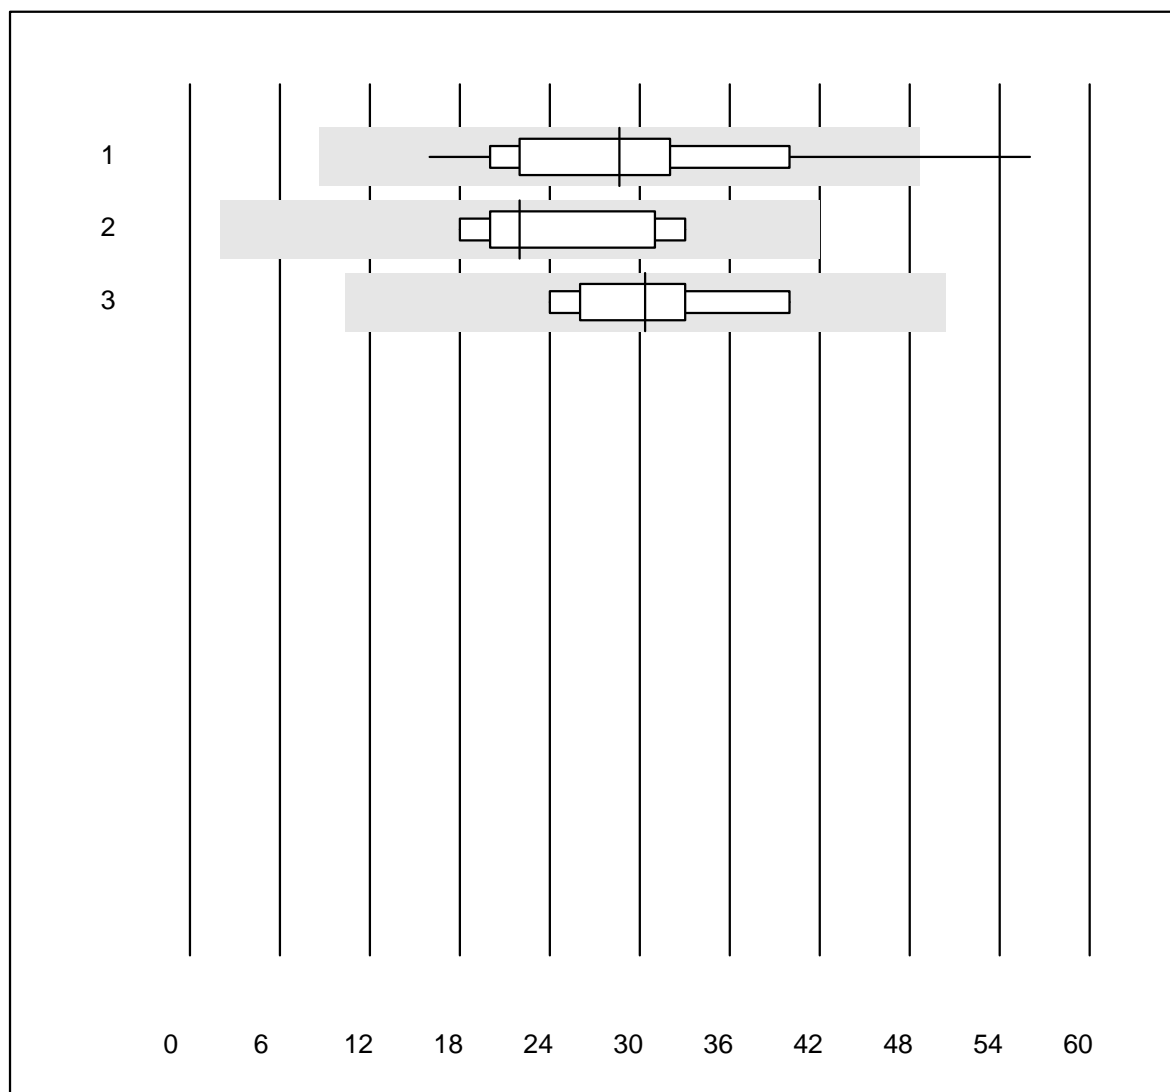


QUALAB Tolérance : 25 %
(< 80.0: +/- 20.0 G/l)

Thrombocytes (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	93	94.6	4.3	1.1	28.6	30.0	e*
2 Advia	5	100.0	0.0	0.0	22.0	27.3	e*
3 Yumizen/Pentra	14	100.0	0.0	0.0	30.4	18.5	e*

Neutrophiles

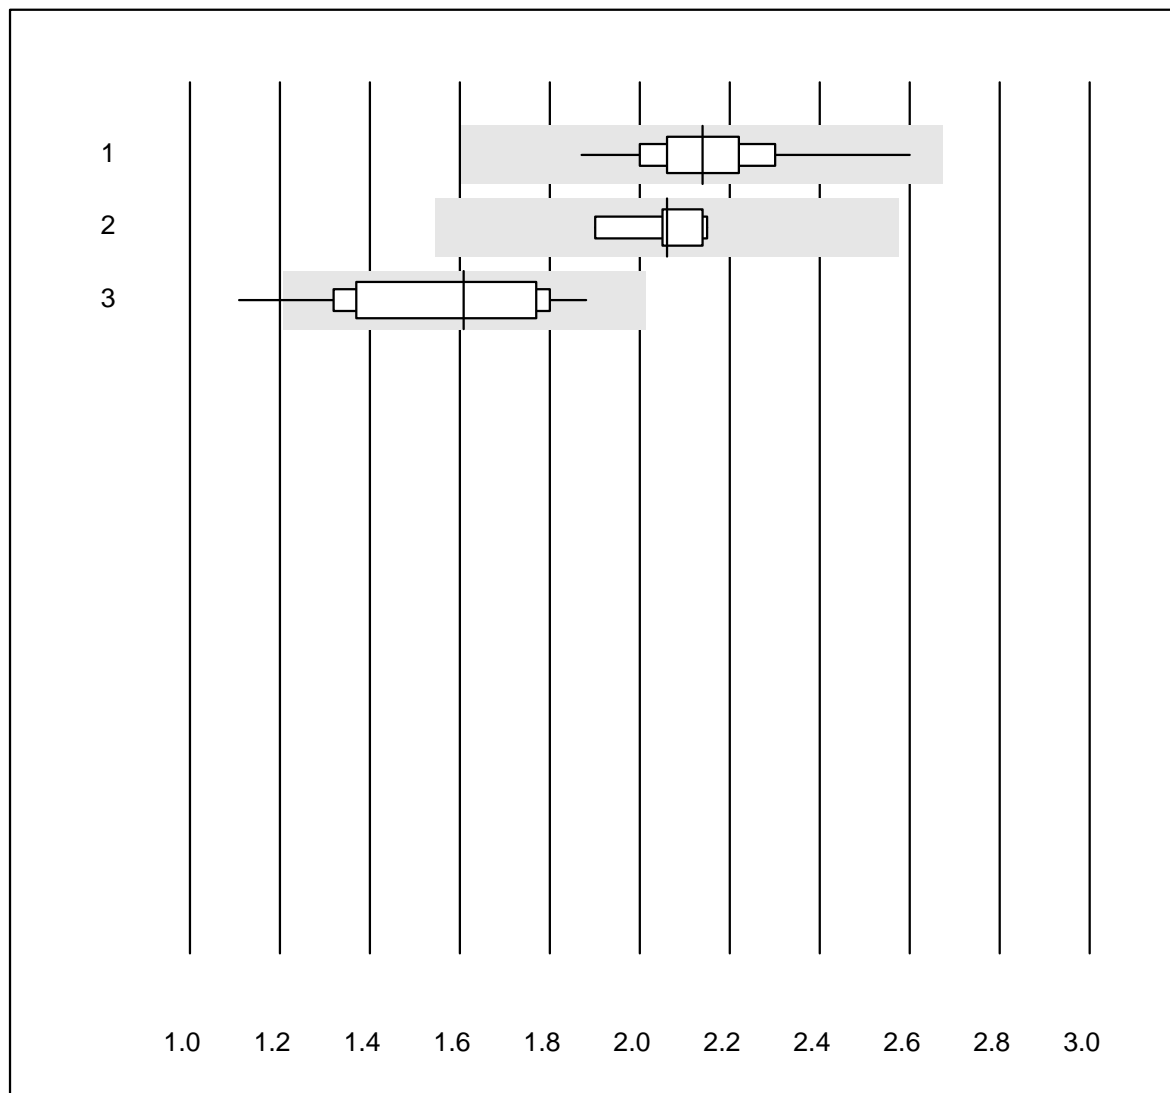


Tolérance MQ : 25 %

Neutrophiles (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	93	100.0	0.0	0.0	2.14	5.7	e
2 Advia	5	100.0	0.0	0.0	2.06	4.9	e
3 Yumizen/Pentra	13	84.6	7.7	7.7	1.61	14.4	e*

Lymphocytes

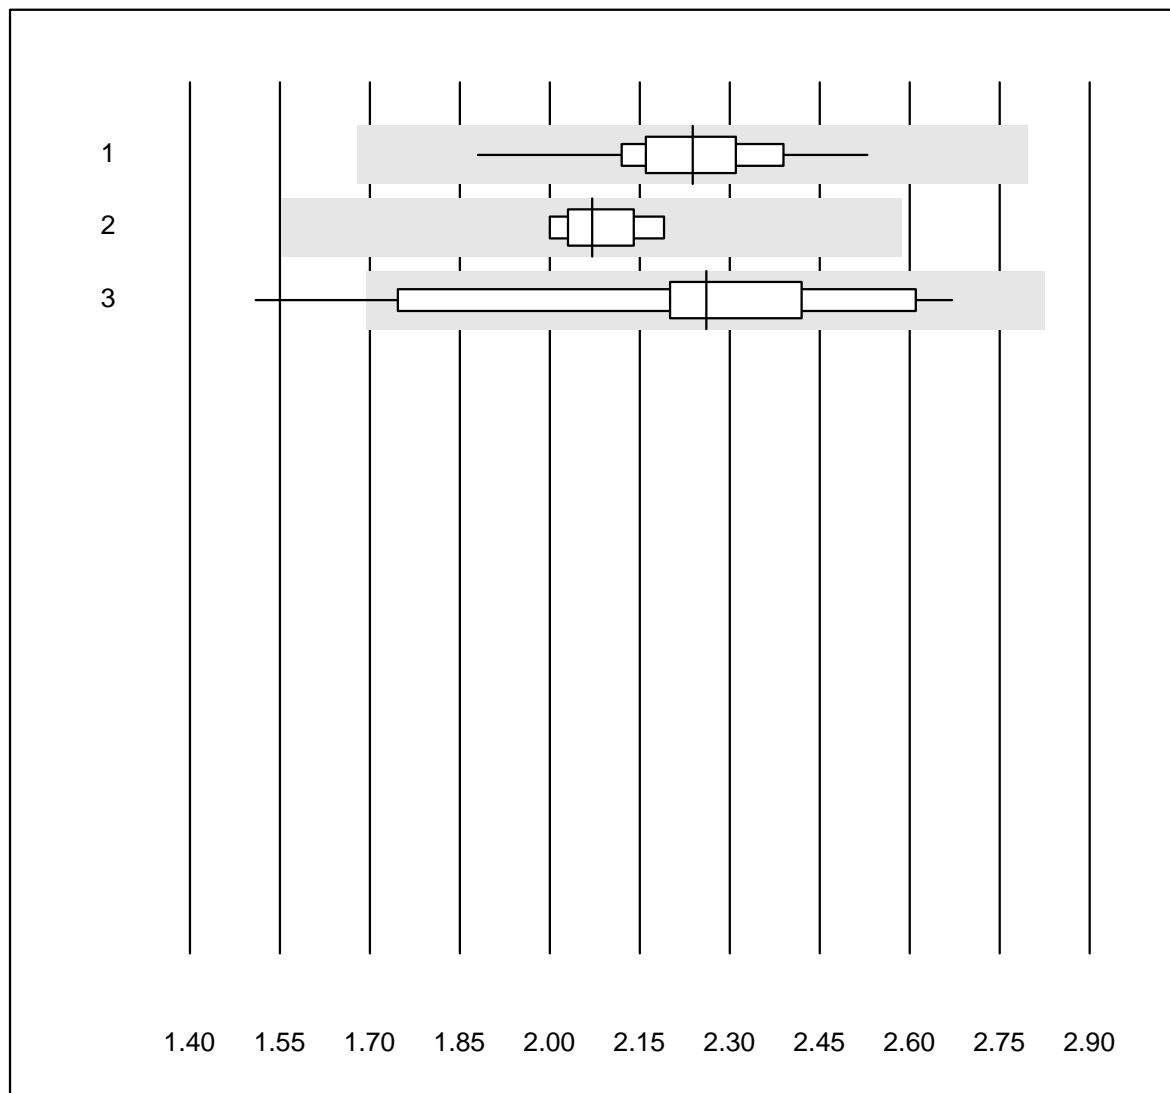


Tolérance MQ : 25 %

Lymphocytes (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	93	98.9	0.0	1.1	2.24	4.9	e
2 Advia	5	100.0	0.0	0.0	2.07	3.8	e
3 Yumizen/Pentra	13	92.3	7.7	0.0	2.26	14.7	e*

Monocytes

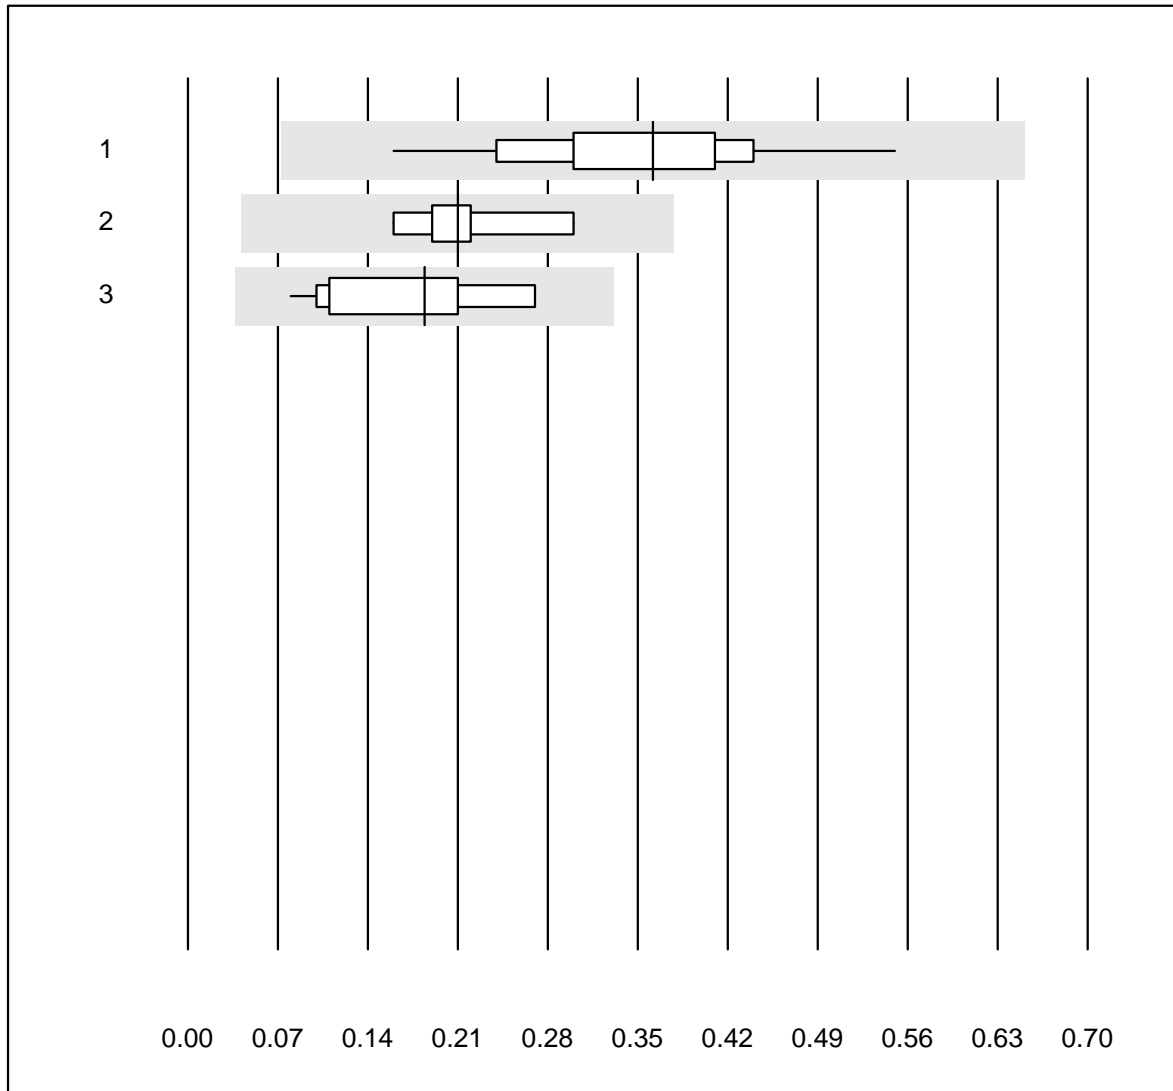


Tolérance MQ : 40 %

Monocytes (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	93	98.9	0.0	1.1	0.36	21.7	a
2 Advia	5	100.0	0.0	0.0	0.21	24.2	a
3 Yumizen/Pentra	13	92.3	0.0	7.7	0.18	37.3	a

Eosinophiles

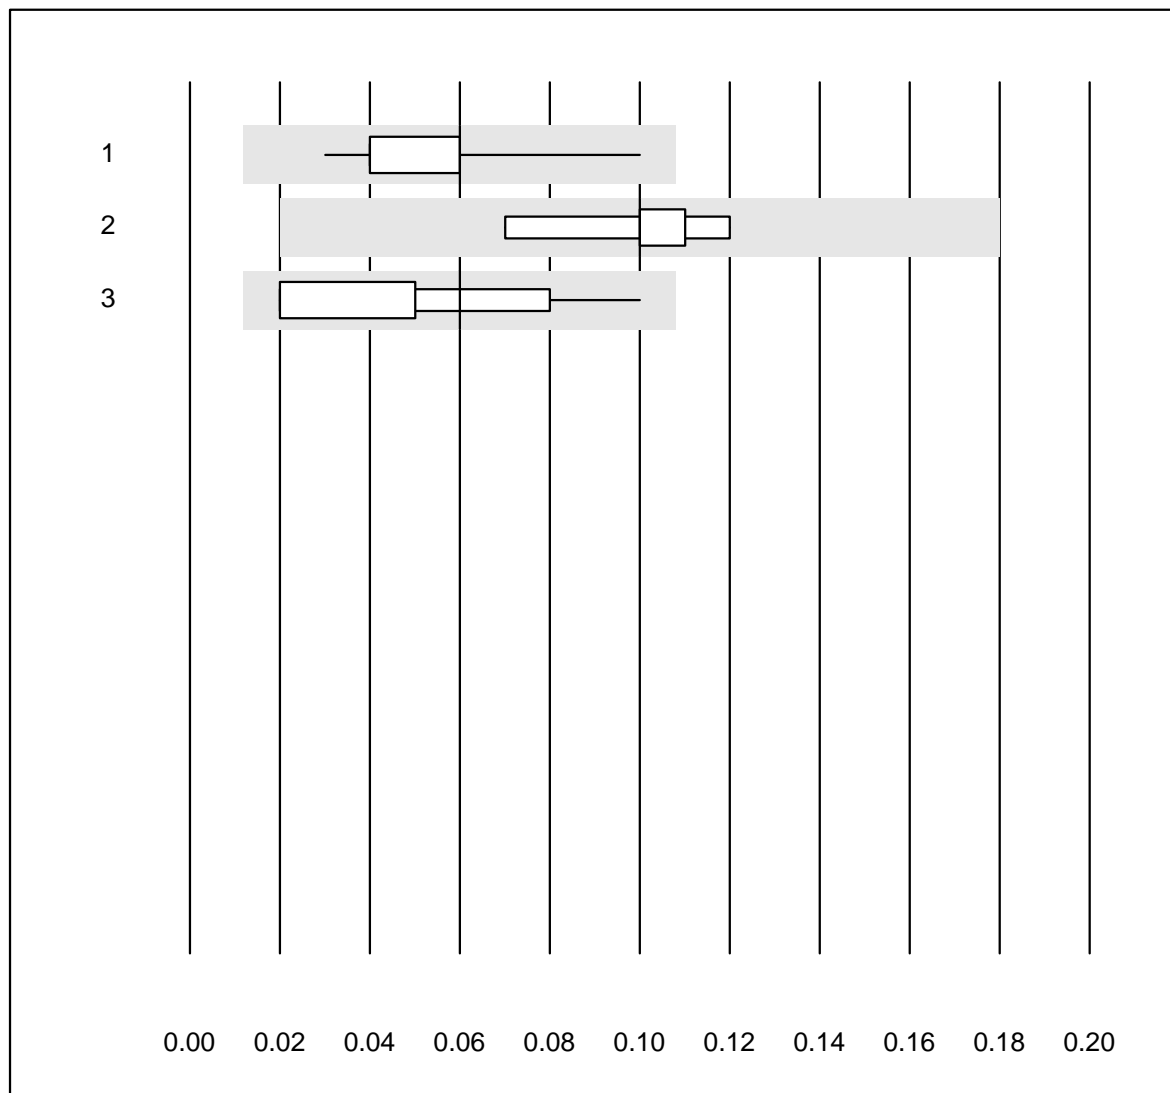


Tolérance MQ : 80 %

Eosinophiles (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	91	100.0	0.0	0.0	0.06	24.5	a
2 Advia	5	100.0	0.0	0.0	0.10	18.7	e
3 Yumizen/Pentra	13	100.0	0.0	0.0	0.06	62.8	a

Basophiles

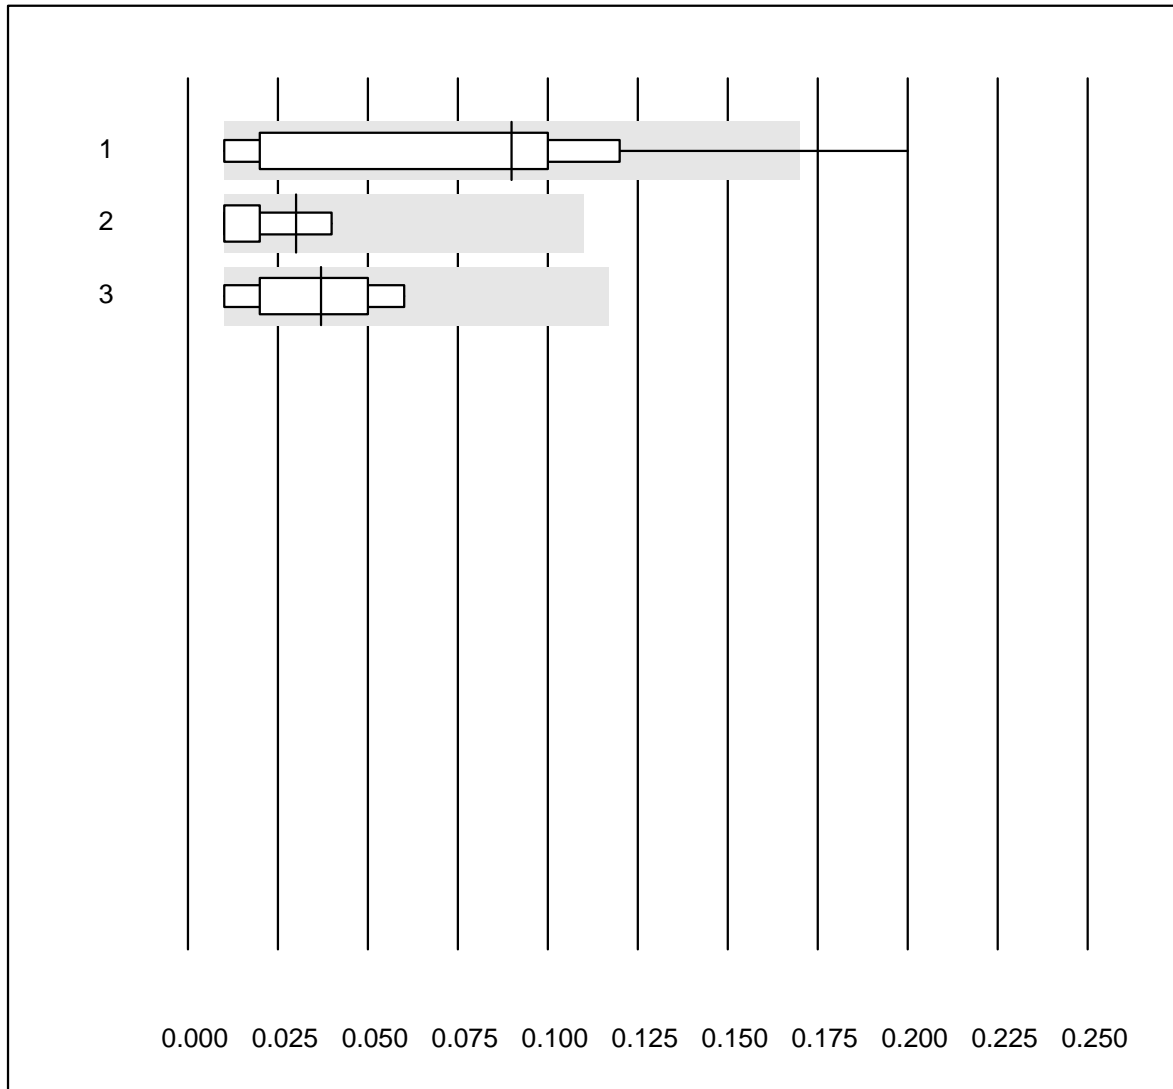


Tolérance MQ : 80 %
 (< 0.10: +/- 0.08 G/l)

Basophiles (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	91	74.7	25.3	0.0	0.09	68.7	a
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	0.03	70.7	a
3 Yumizen/Pentra	13	100.0	0.0	0.0	0.04	52.3	e*

MCV

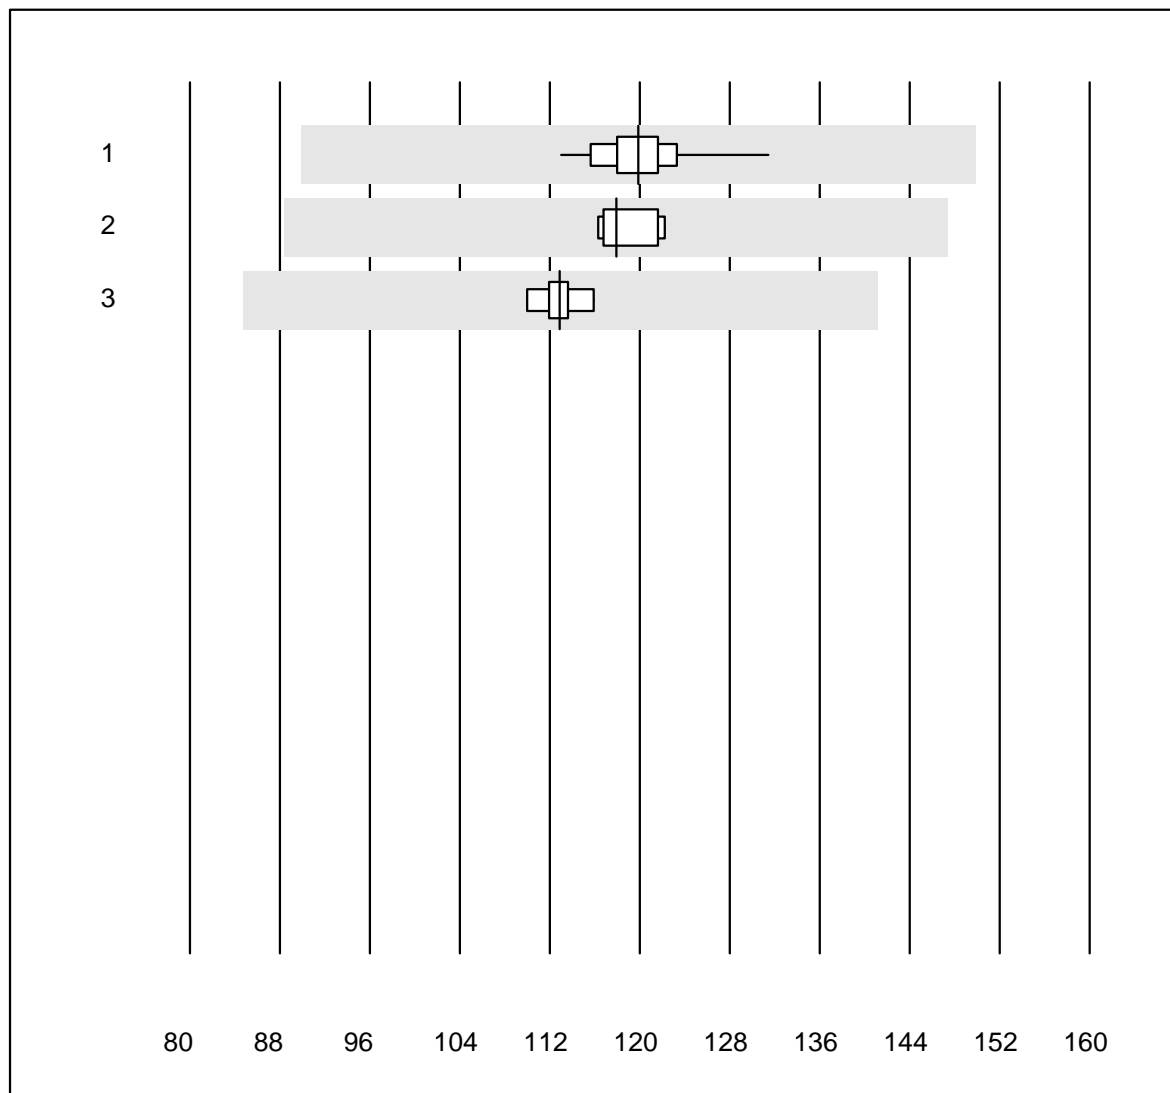


Tolérance MQ : 25 %

MCV (fl)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	82	100.0	0.0	0.0	119.9	2.6	e
2 Advia	5	100.0	0.0	0.0	117.9	2.3	e
3 Yumizen/Pentra	9	100.0	0.0	0.0	112.9	1.7	e

MCH

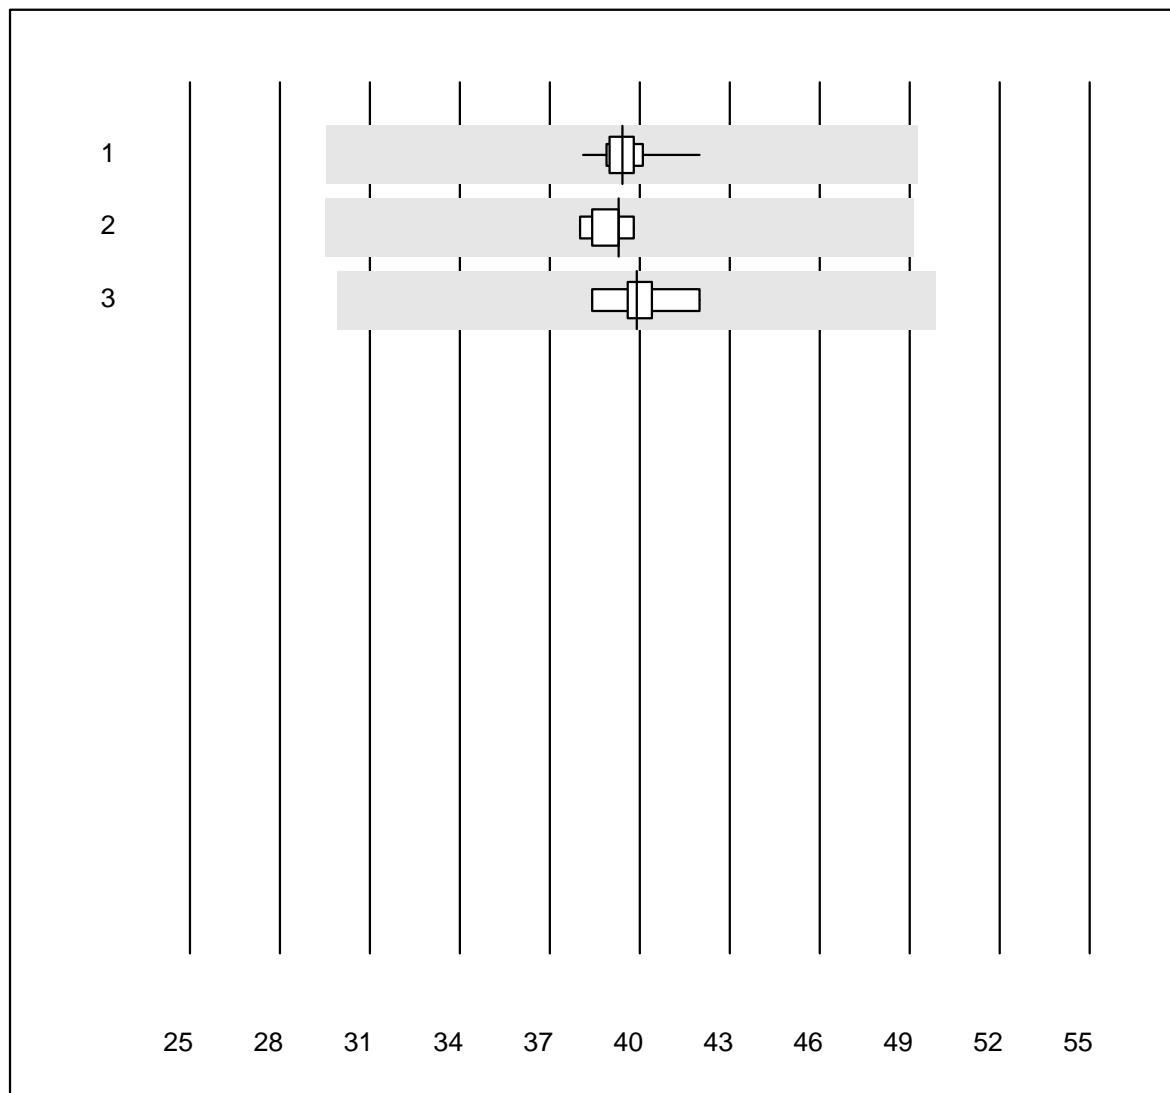


Tolérance MQ : 25 %

MCH (pg)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	83	100.0	0.0	0.0	39.4	1.4	e
2 Advia	5	100.0	0.0	0.0	39.3	1.9	e
3 Yumizen/Pentra	9	100.0	0.0	0.0	39.9	2.4	e

MCHC

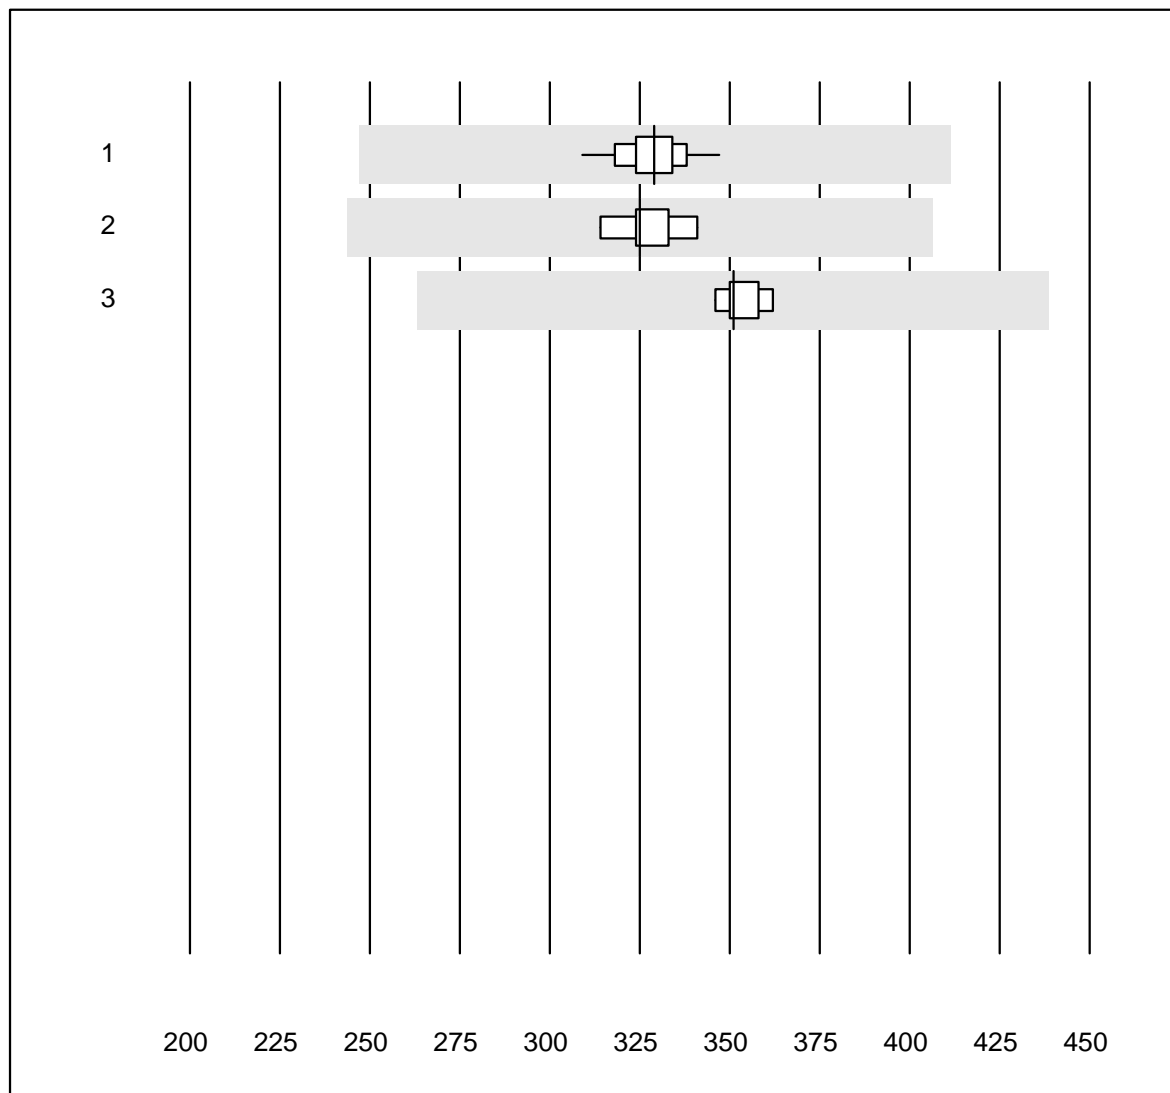


Tolérance MQ : 25 %

MCHC (g/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	84	100.0	0.0	0.0	329	2.4	e
2 Advia	5	100.0	0.0	0.0	325	3.1	e
3 Yumizen/Pentra	9	100.0	0.0	0.0	351	1.6	e

RDW

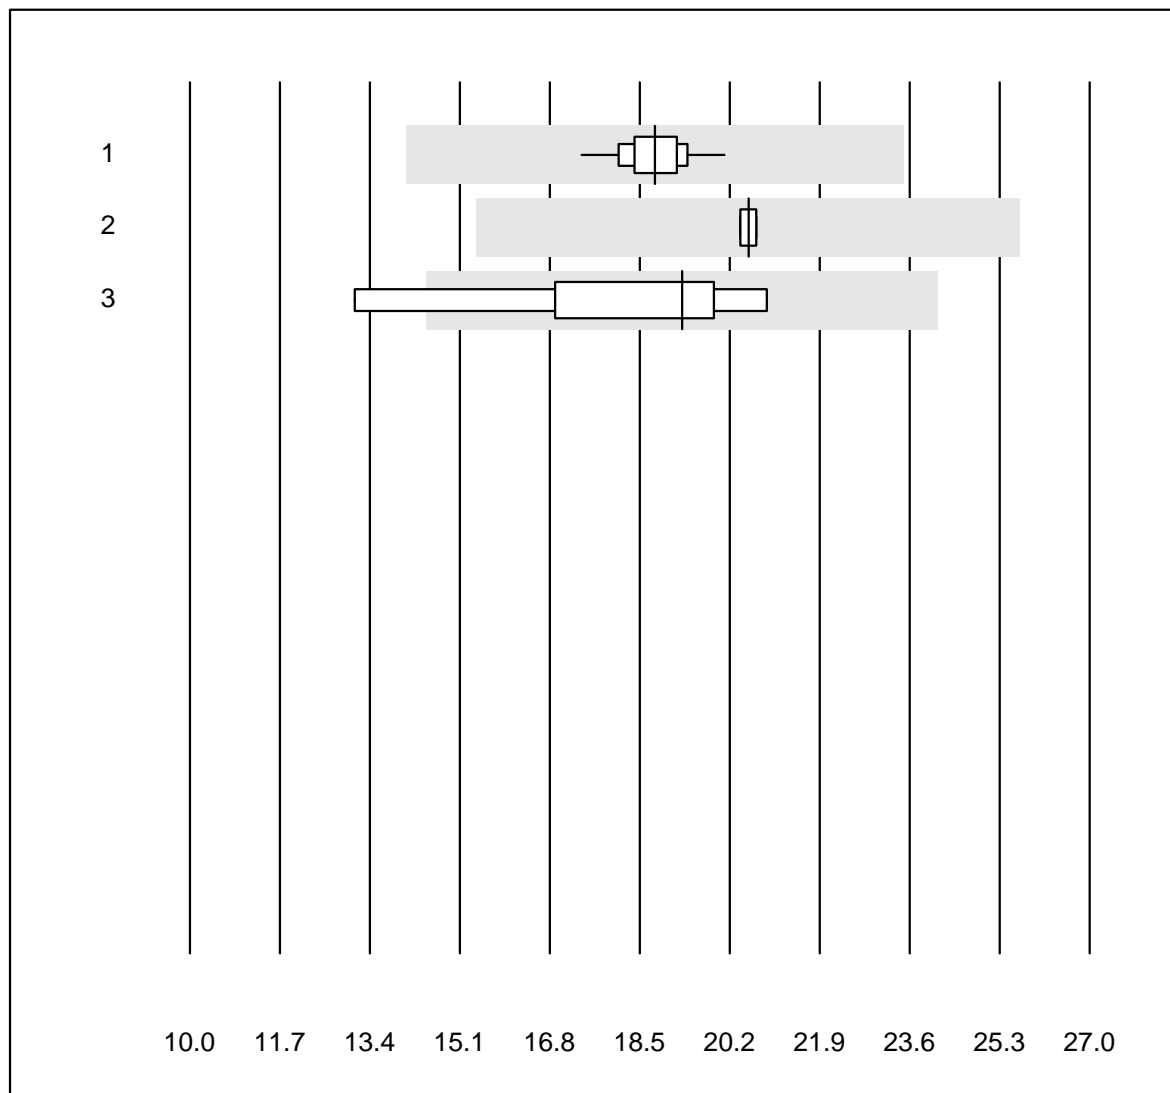


Tolérance MQ : 25 %

RDW (%)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	80	100.0	0.0	0.0	18.8	2.8	e
2 Advia	4	100.0	0.0	0.0	20.6	0.8	e
3 Yumizen/Pentra	8	87.5	12.5	0.0	19.3	13.7	e*

Immature Granulocytes

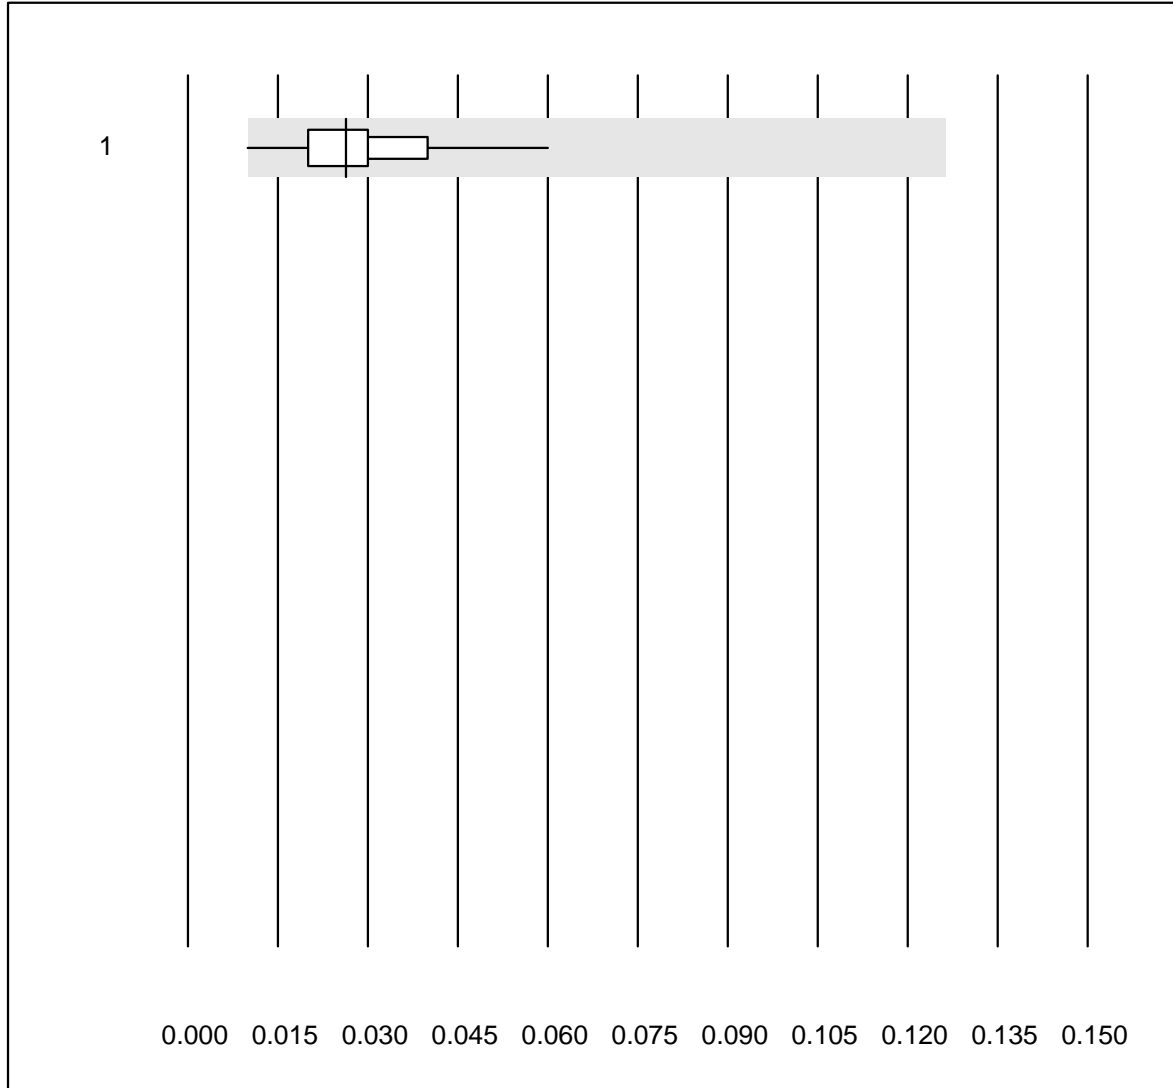


Tolérance MQ : 25 %
 (< 0.10: +/- 0.10 G/l)

Immature Granulocytes (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	70	100.0	0.0	0.0	0.03	36.2	e*

Réticulocytes

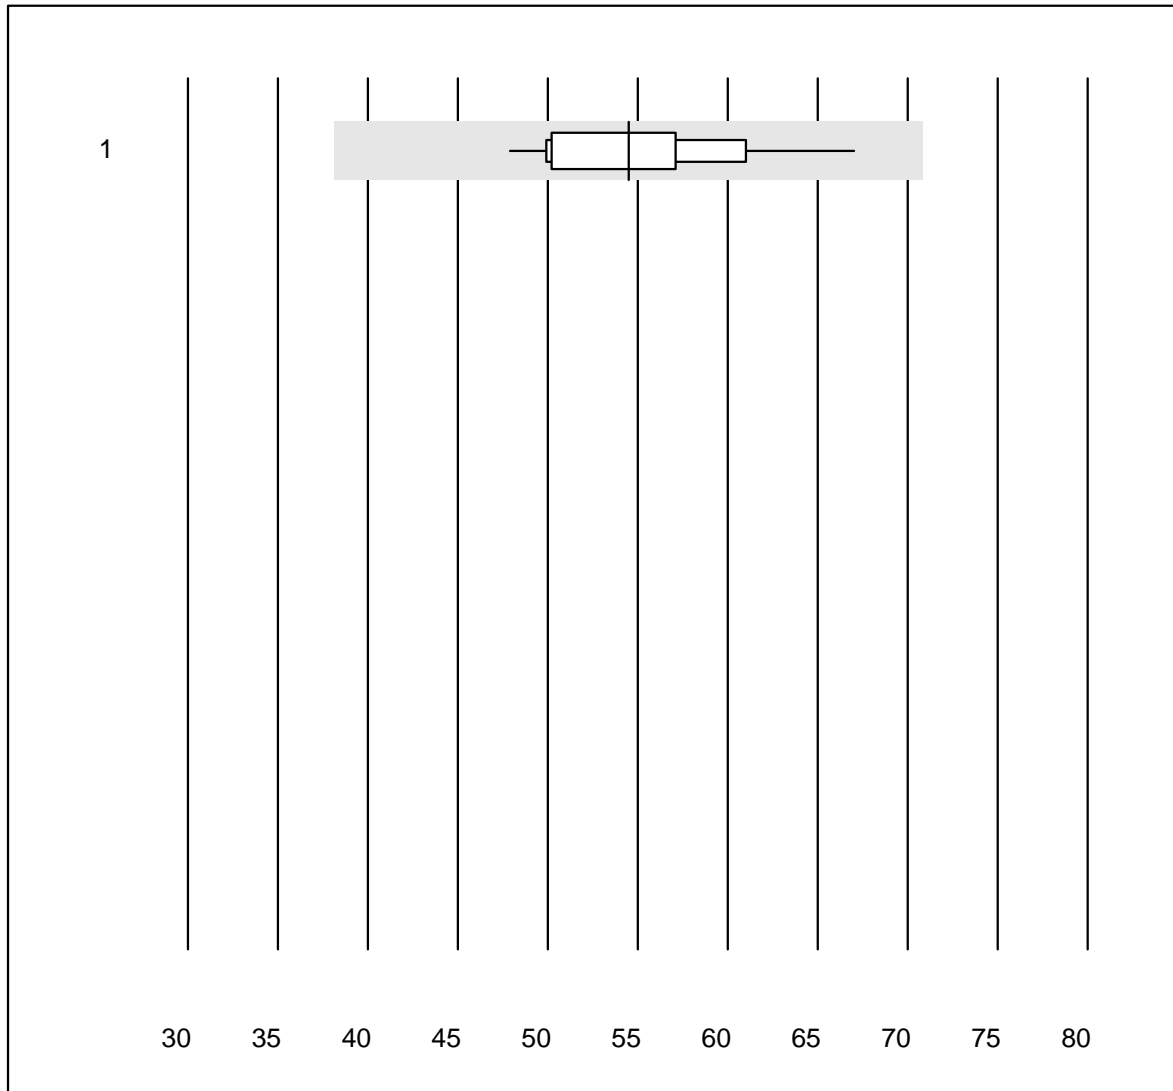


Tolérance MQ : 30 %

Réticulocytes (G/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Sysmex	48	100.0	0.0	0.0	54.5	7.8	e

Index hémolytique échantillon A

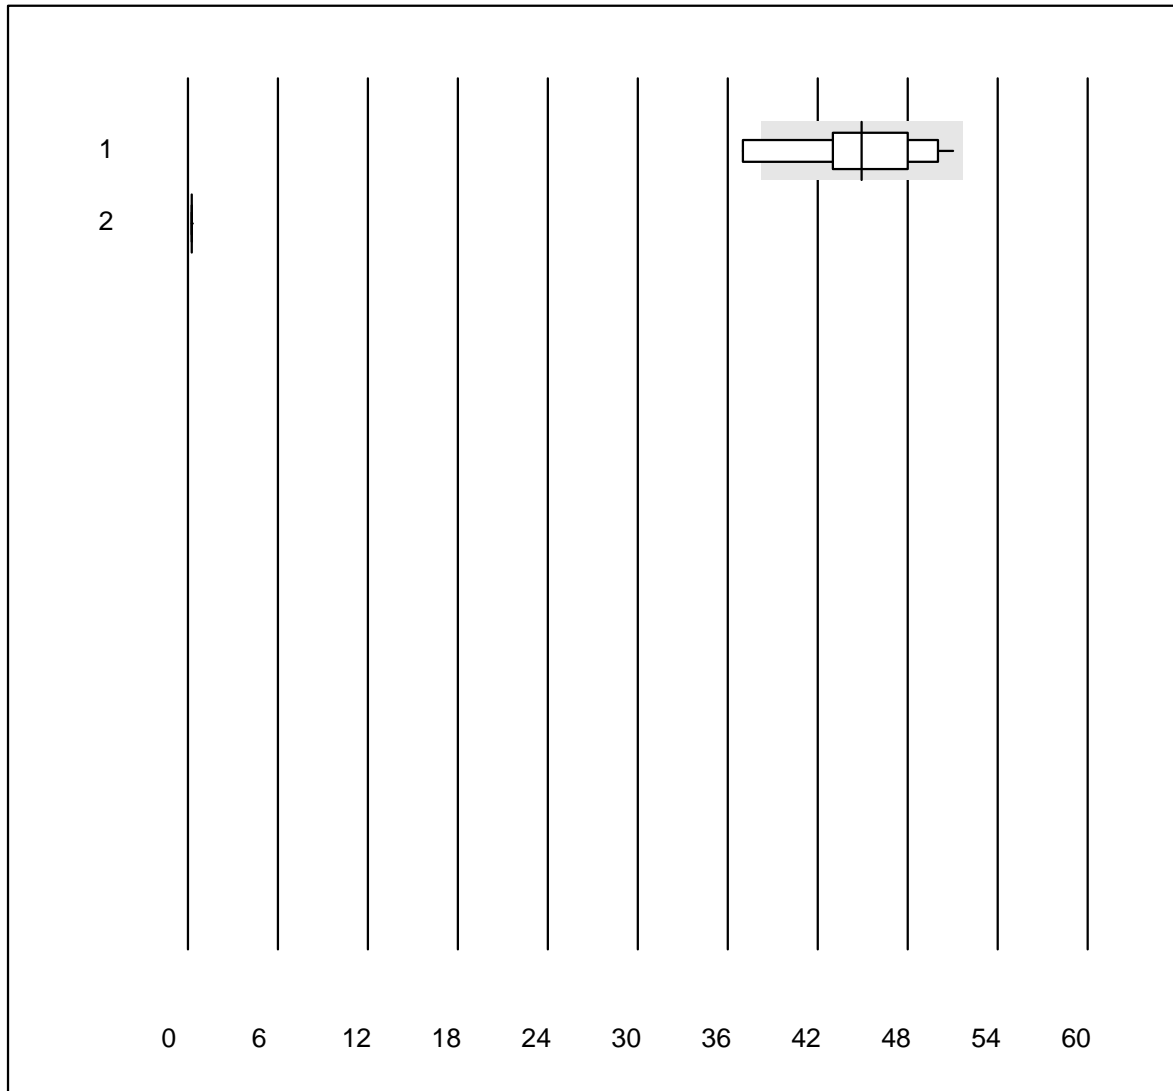


Tolérance MQ : 15 %

Index hémolytique échantillon A ()

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	18	88.9	11.1	0.0	44.94	8.9	e*
2 Architect	6	66.7	0.0	33.3	0.27	1.9	e

Index hémolytique échantillon B

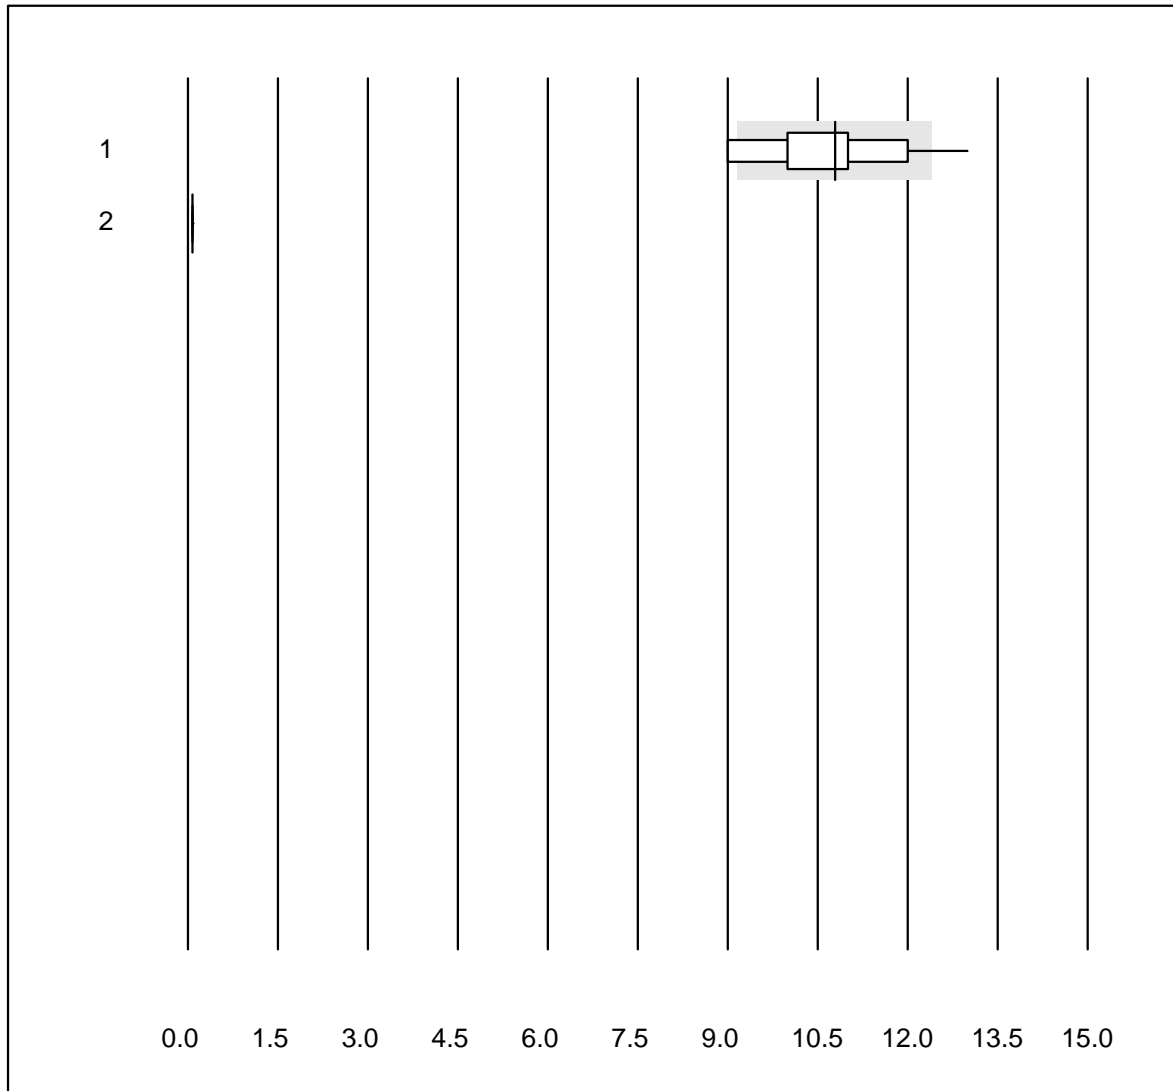


Tolérance MQ : 15 %

Index hémolytique échantillon B ()

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	18	61.1	16.7	22.2	10.79	10.4	e*
2 Architect	7	71.4	0.0	28.6	0.08	7.4	e*

Vitesse de sédimentation 1h

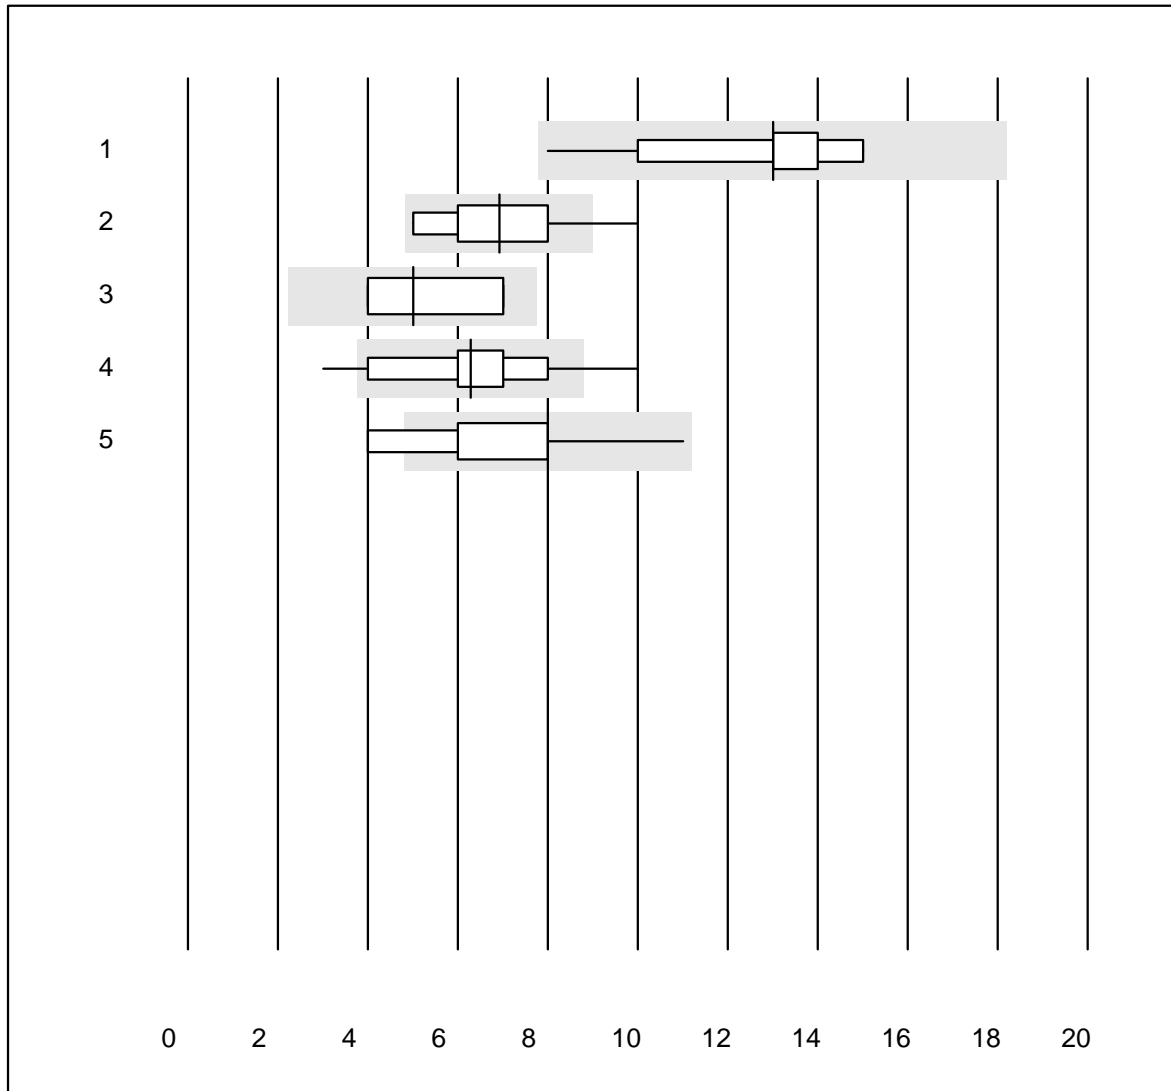


Tolérance MQ : 30 %

Vitesse de sédimentation 1h (mm/h)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 MINI-CUBE	15	86.7	0.0	13.3	13	16.3	a
2 Sarstedt Sedivette	14	85.8	7.1	7.1	7	20.0	a
3 Sarstedt Microvette	4	100.0	0.0	0.0	5	26.1	a
4 BD Seditainer	40	92.5	7.5	0.0	6	23.4	a
5 Autres méthodes	11	81.8	18.2	0.0	8	29.3	a

Vitesse de sédimentation 2h

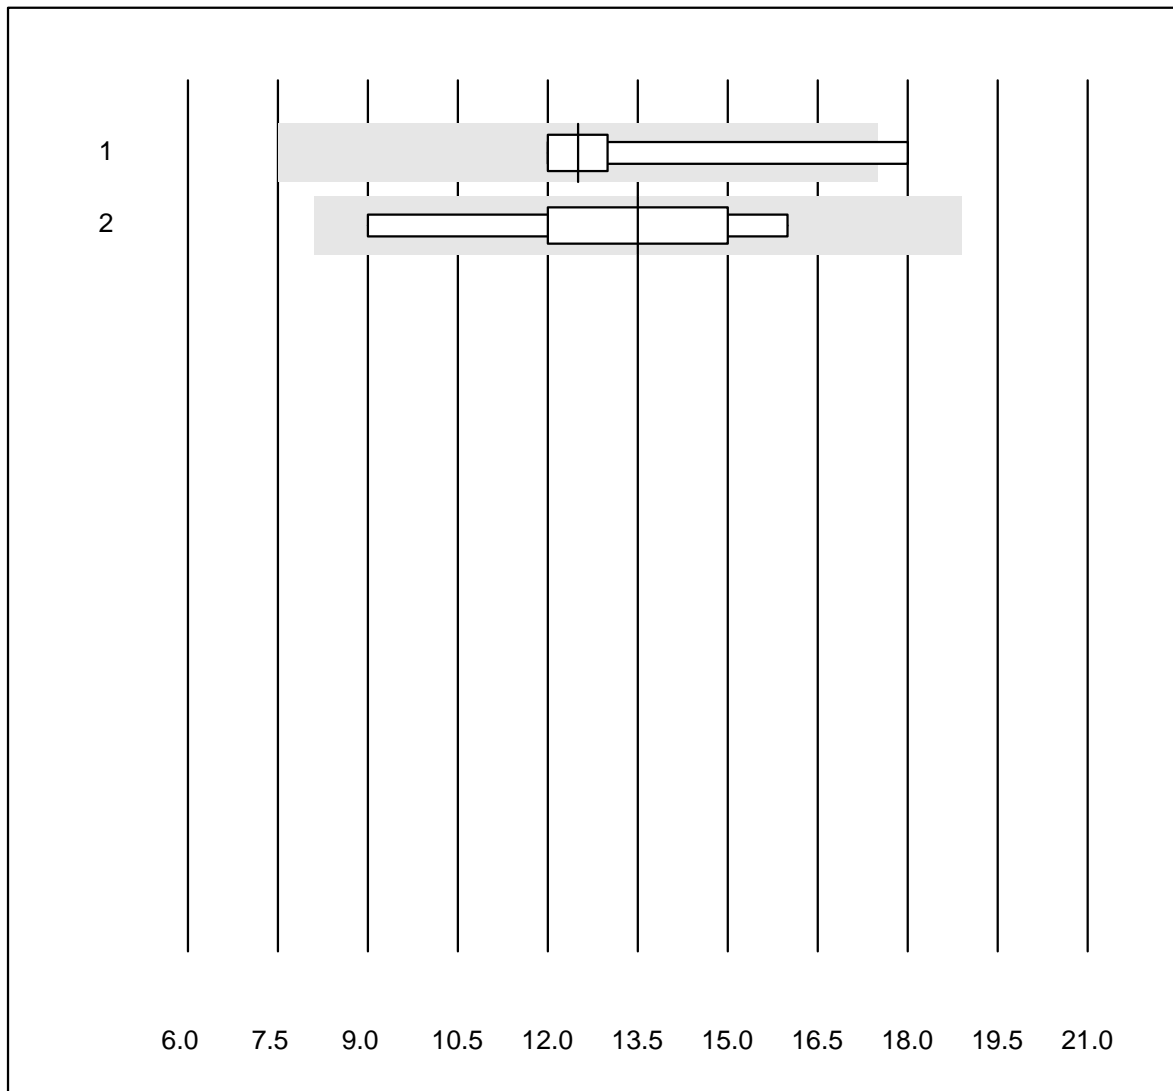

Tolérance MQ : 30 %

Vitesse de sédimentation 2h (mm/2h)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 BD Seditainer	5	80.0	20.0	0.0	13	19.5	a
2 Autres méthodes	5	100.0	0.0	0.0	14	21.0	a

Hémoglobine HS




Tolérance MQ : 9 %

Hémoglobine HS (g/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 PixCell HemoScreen	5	80.0	20.0	0.0	156.0	7.3	e*

Hématocrit HS

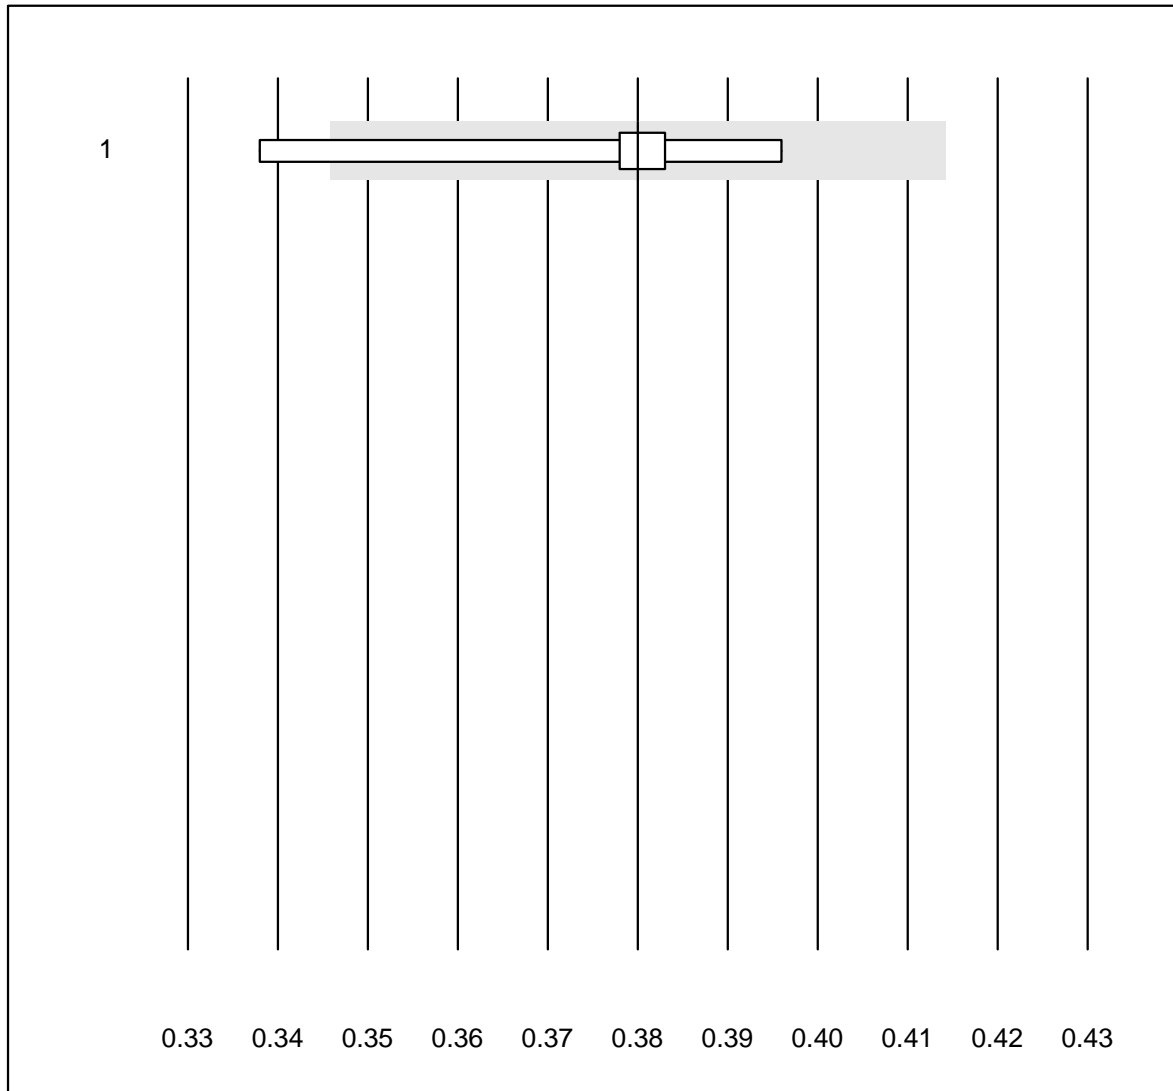


Tolérance MQ : 9 %

Hématocrit HS (l/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 PixCell HemoScreen	5	80.0	20.0	0.0	0.4	5.8	e*

Erythrocytes HS

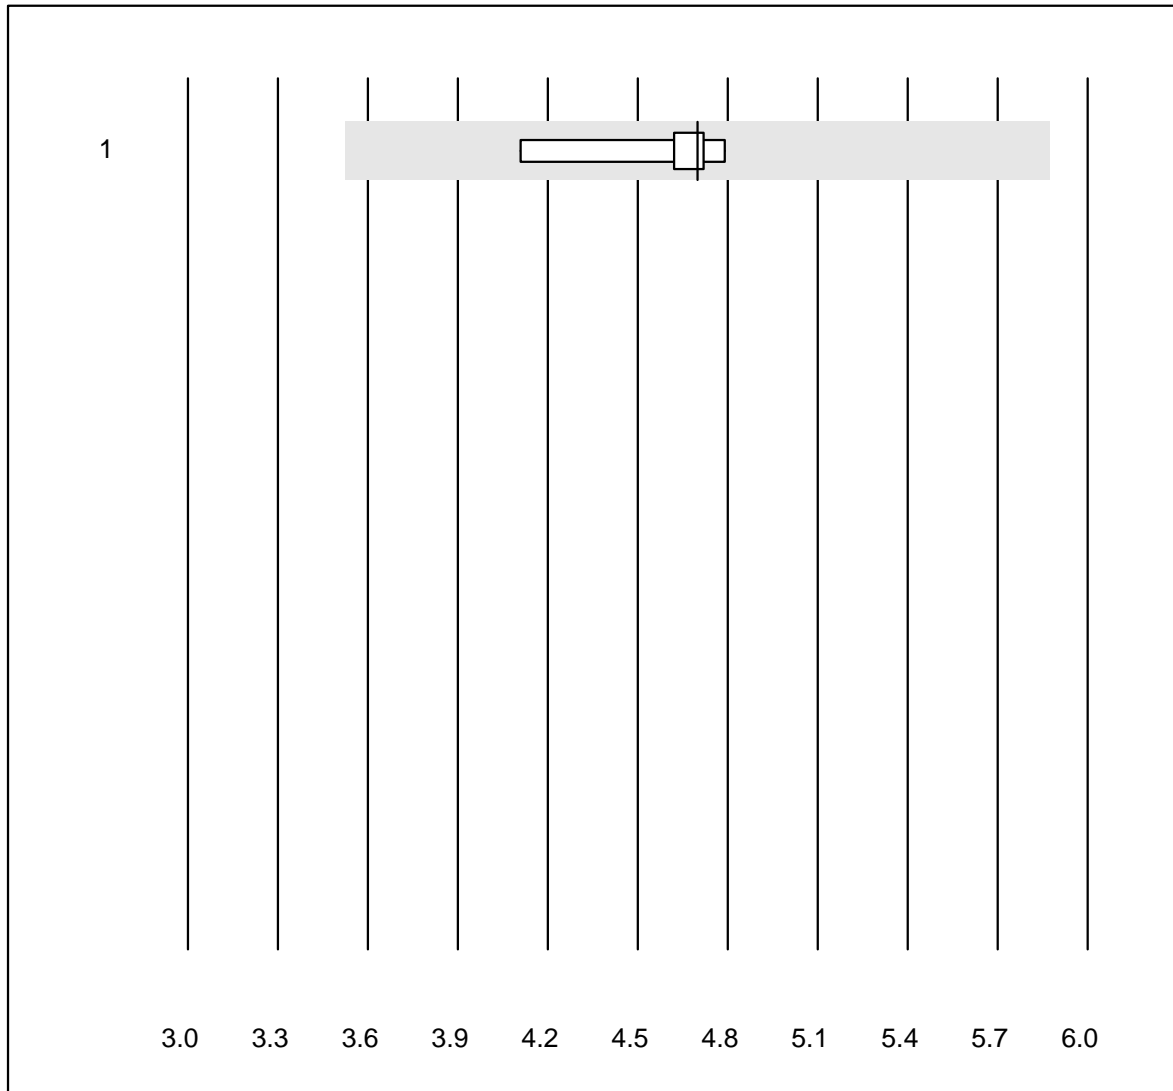


Tolérance MQ : 25 %

Erythrocytes HS (T/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 PixCell HemoScreen	5	100.0	0.0	0.0	4.70	6.0	e

Leucocytes HS

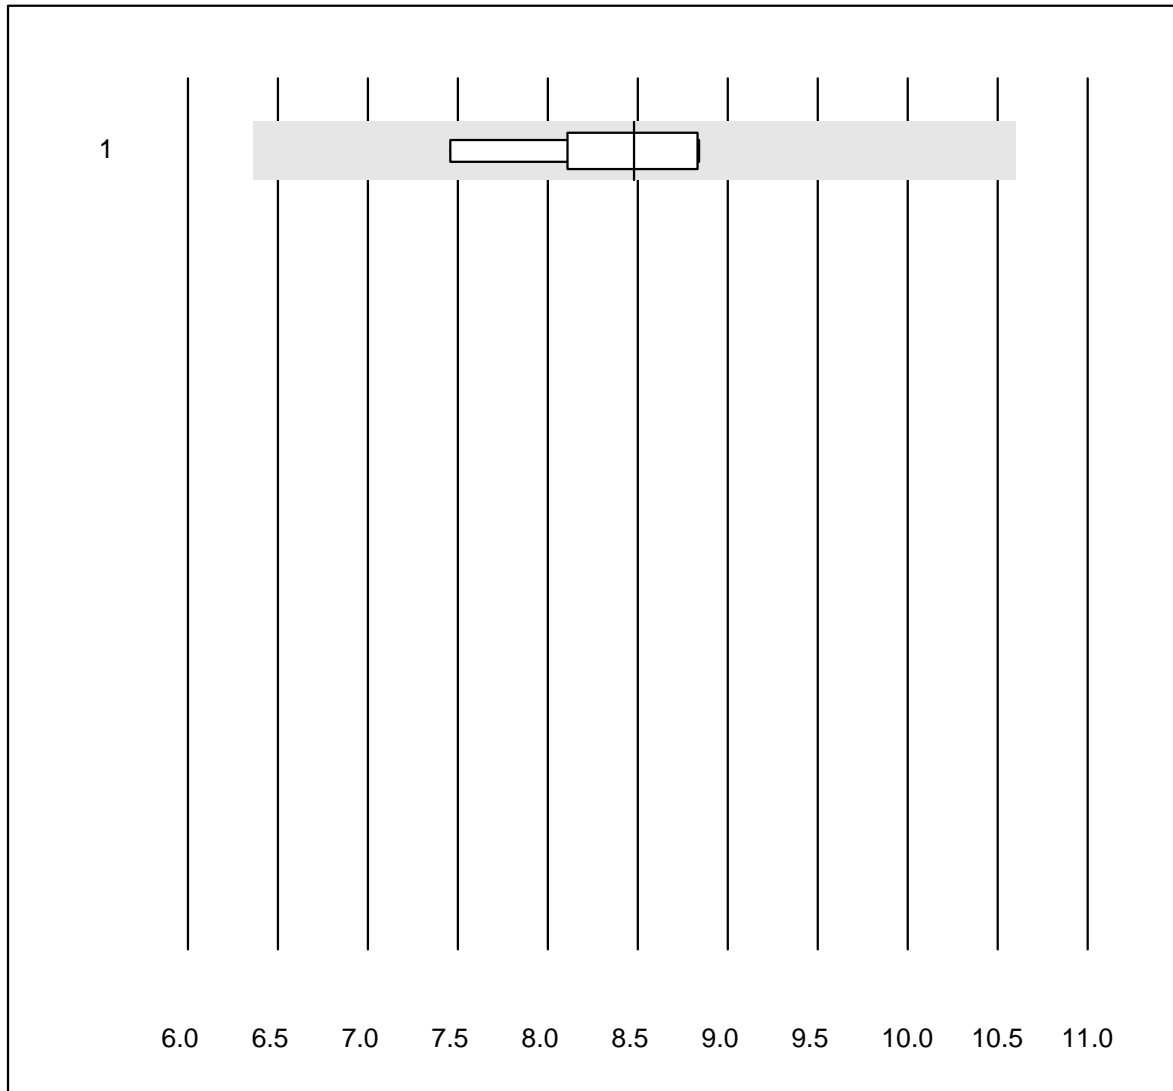


Tolérance MQ : 25 %

Leucocytes HS (G/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 PixCell HemoScreen	5	100.0	0.0	0.0	8.48	6.9	e*

Thrombocytes HS

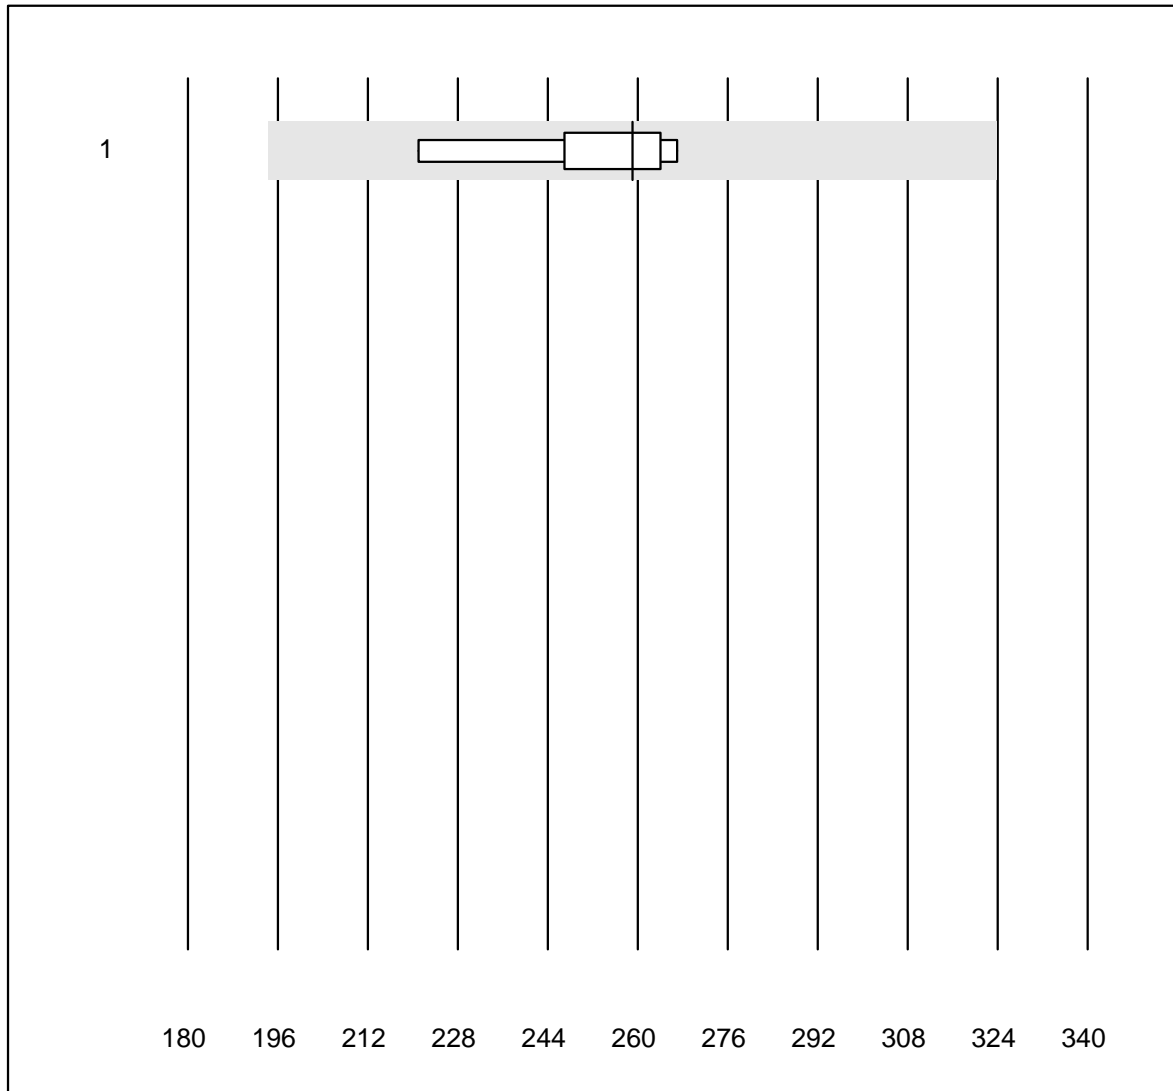


Tolérance MQ : 25 %

Thrombocytes HS (G/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 PixCell HemoScreen	5	100.0	0.0	0.0	259.0	7.4	e*

CRP

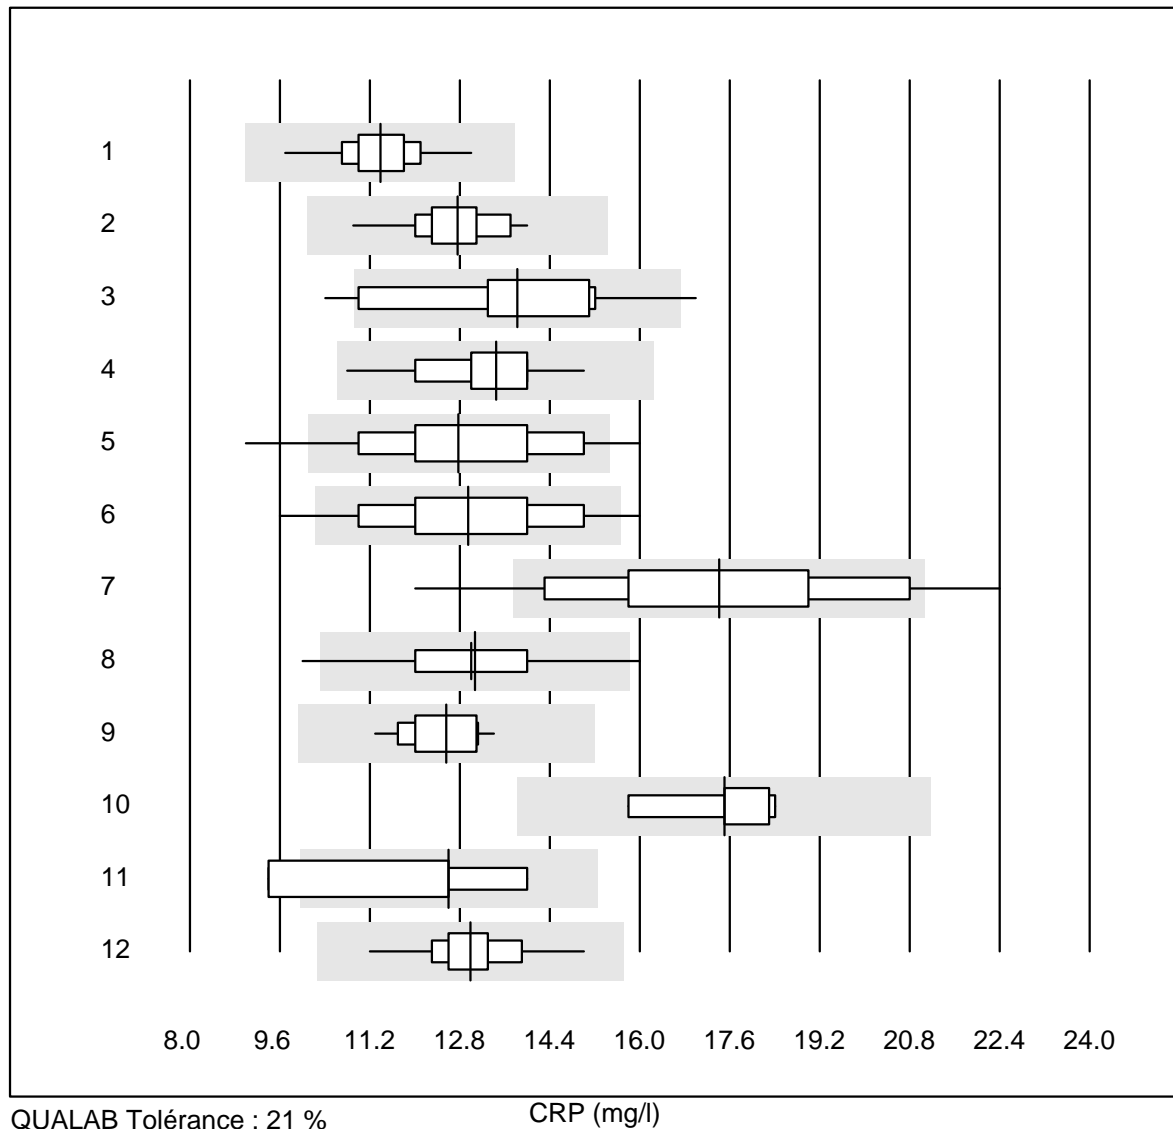

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas b101	324	98.8	0.0	1.2	11.4	4.9	e
2 Cobas	26	100.0	0.0	0.0	12.8	5.3	e
3 Turbidimétrie	13	84.6	15.4	0.0	13.8	12.6	e*
4 Afinion	1193	99.3	0.0	0.7	13.4	5.8	e
5 NycoCard SingleTest-	90	74.5	11.1	14.4	12.8	12.9	e
6 Quick Read go	93	95.6	2.2	2.2	12.9	10.8	e
7 Eurolyser	89	71.9	7.9	20.2	17.4	13.3	e
8 Fuji Dri-Chem	17	82.3	11.8	5.9	13.1	9.5	e
9 Autolyser/DiaSys	12	91.7	0.0	8.3	12.6	5.3	e
10 Piccolo	6	100.0	0.0	0.0	17.5	5.3	e
11 Nephelométrie	5	40.0	40.0	20.0	12.6	19.6	e*
12 Celltac chemi	41	100.0	0.0	0.0	13.0	5.7	e

CRP

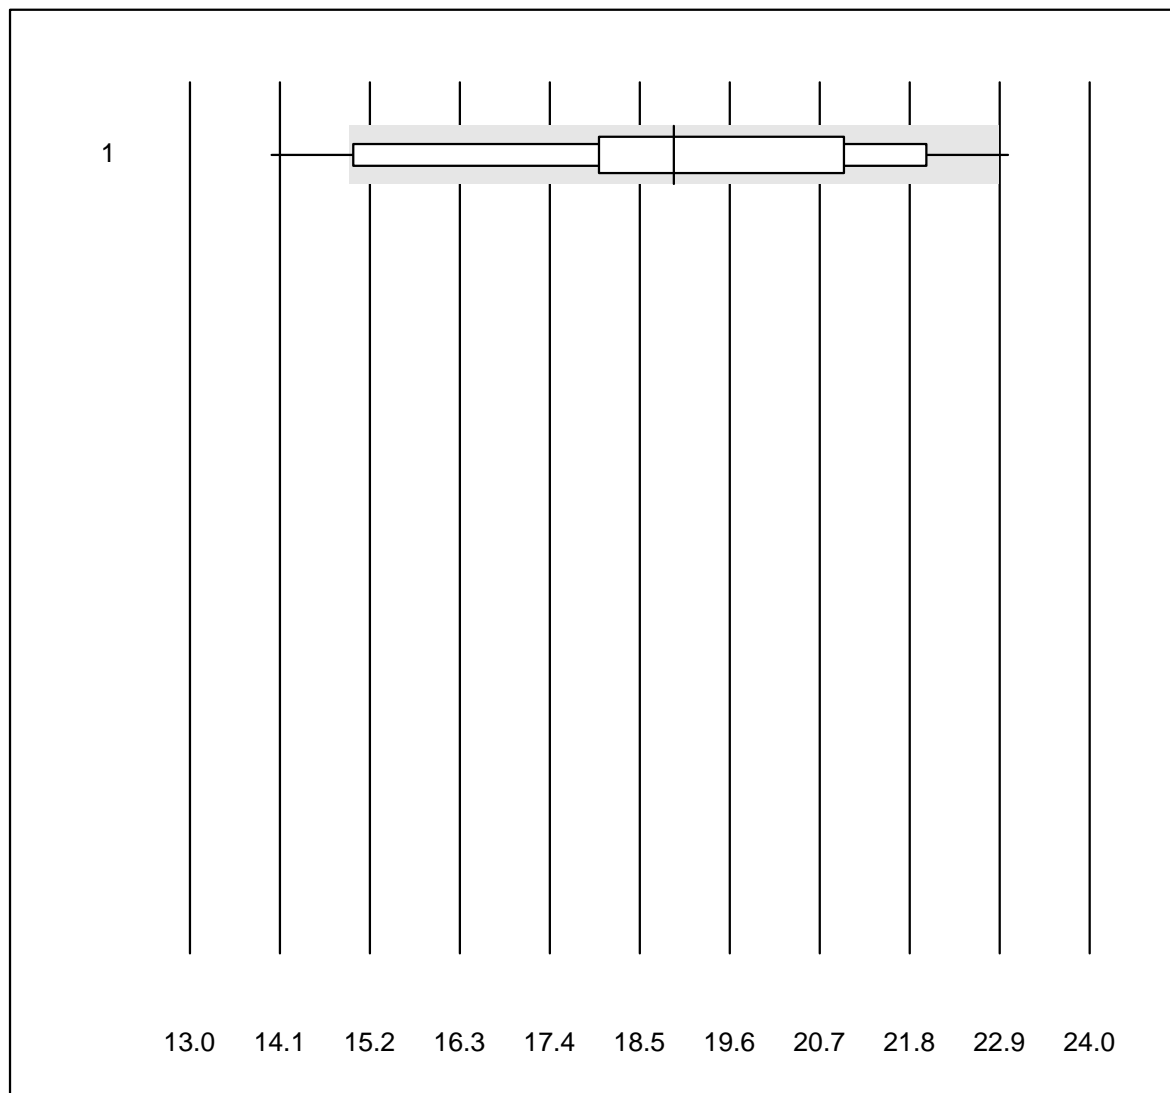


QUALAB Tolérance : 21 %

CRP (mg/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 QuickRead (sang comp	26	84.7	11.5	3.8	18.9	12.8	e

CRP

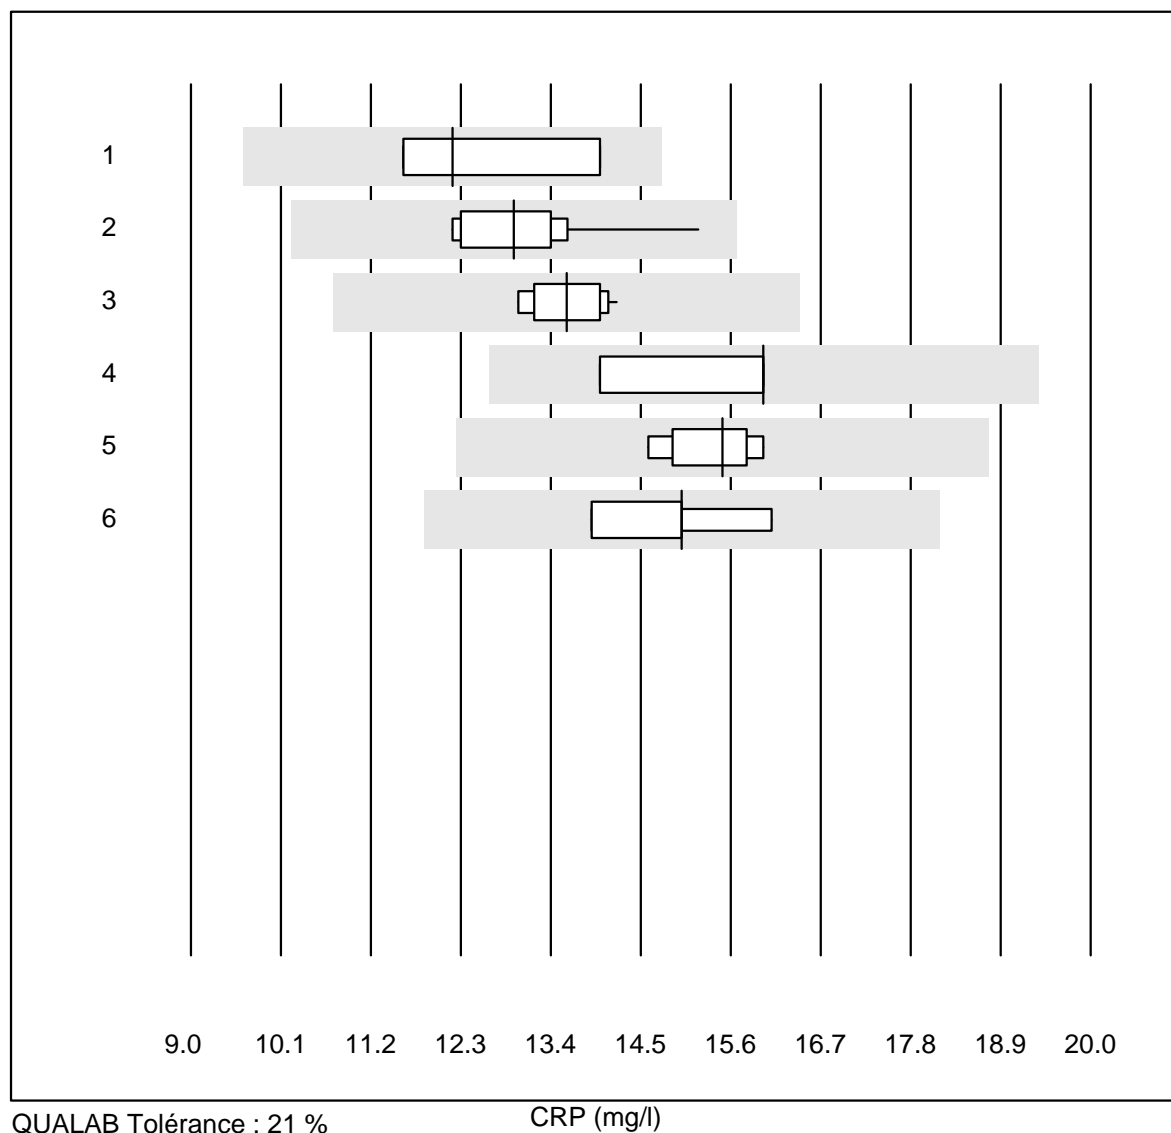

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Lumira Dx	4	75.0	0.0	25.0	12.2	10.1	a
2 Spinit	10	100.0	0.0	0.0	13.0	7.2	e
3 Architect	10	100.0	0.0	0.0	13.6	3.4	e
4 AQT 90 FLEX	7	100.0	0.0	0.0	16.0	6.2	e
5 Spotchem D-Concept	5	100.0	0.0	0.0	15.5	3.9	e
6 Autres méthodes	5	80.0	0.0	20.0	15.0	6.4	e*

IgG

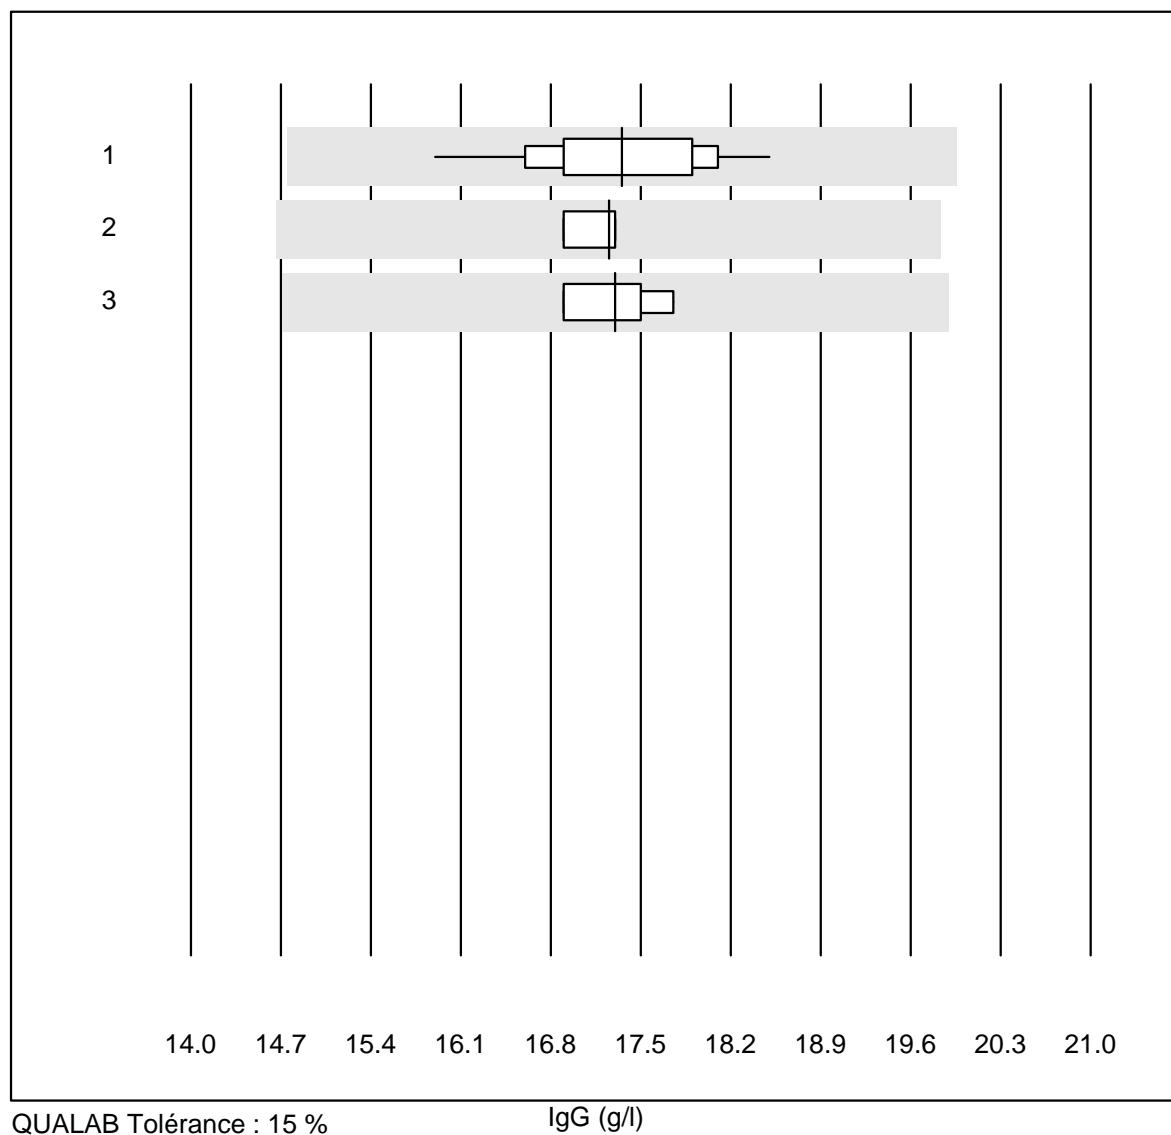


QUALAB Tolérance : 15 %

IgG (g/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Turbidimétrie	19	94.7	0.0	5.3	17.35	3.7	e
2 Nephelométrie	4	75.0	0.0	25.0	17.25	1.2	e
3 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	17.30	2.2	e

IgA

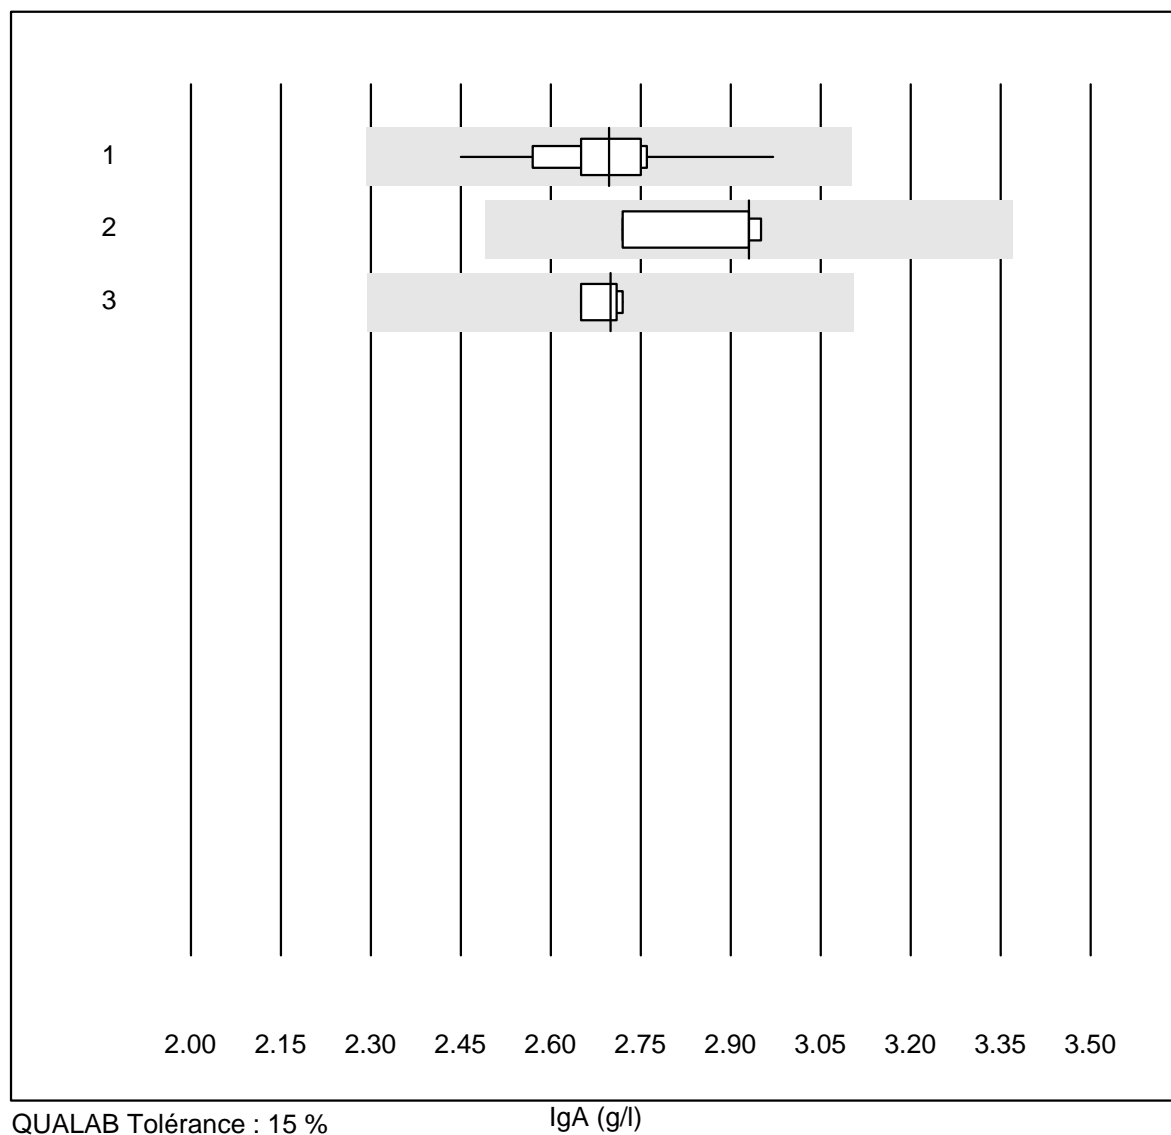


QUALAB Tolérance : 15 %

IgA (g/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Turbidimétrie	17	100.0	0.0	0.0	2.70	4.0	e
2 Nephelométrie	5	80.0	0.0	20.0	2.93	3.8	e
3 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	2.70	1.1	e

IgM

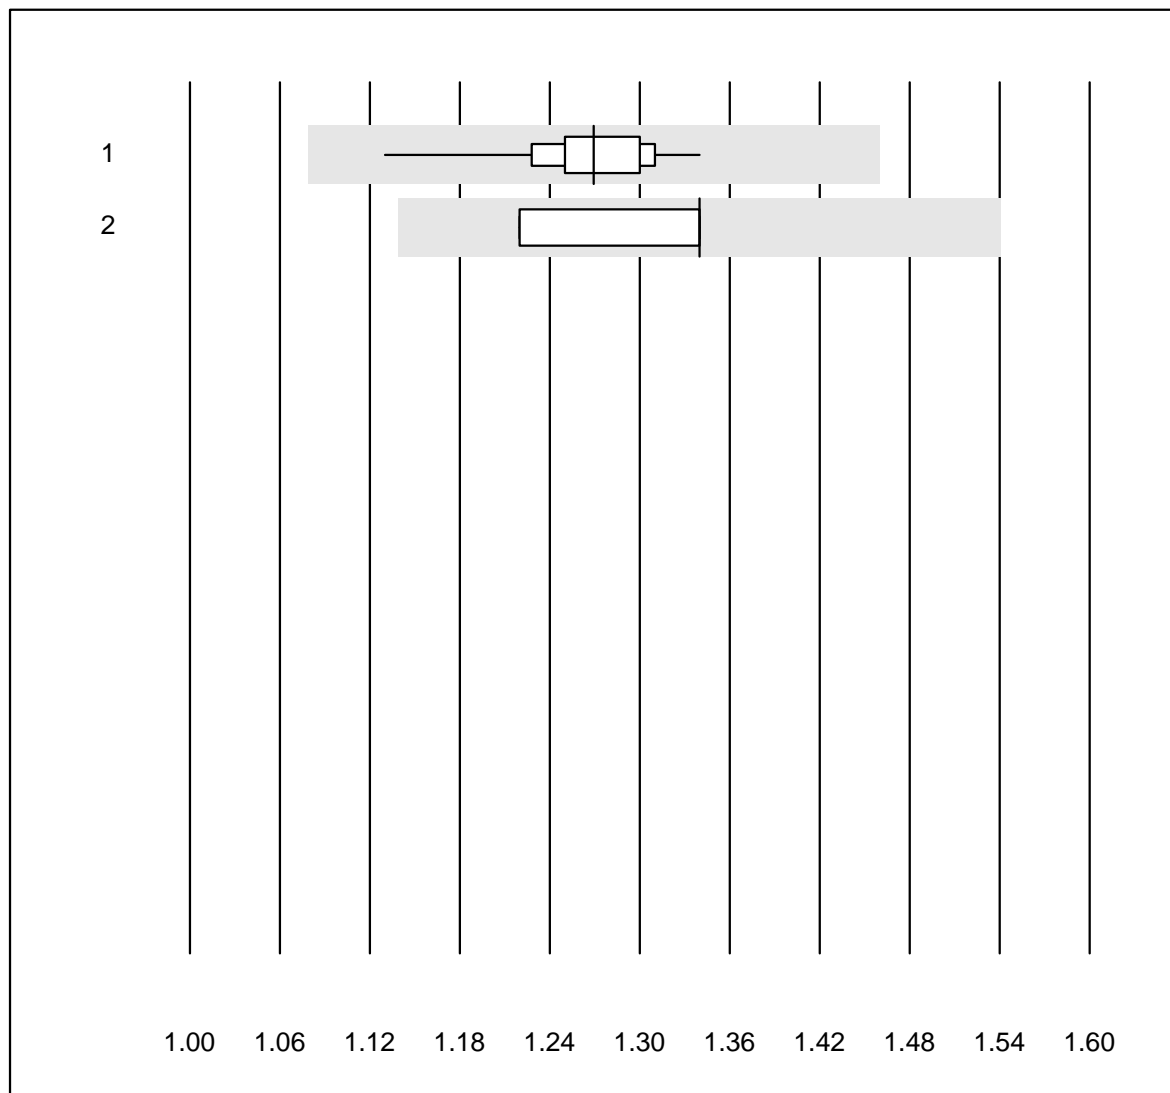


QUALAB Tolérance : 15 %

IgM (g/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Turbidimétrie	18	100.0	0.0	0.0	1.27	3.7	e
2 Néphélométrie	5	80.0	0.0	20.0	1.34	4.4	e*

IgE

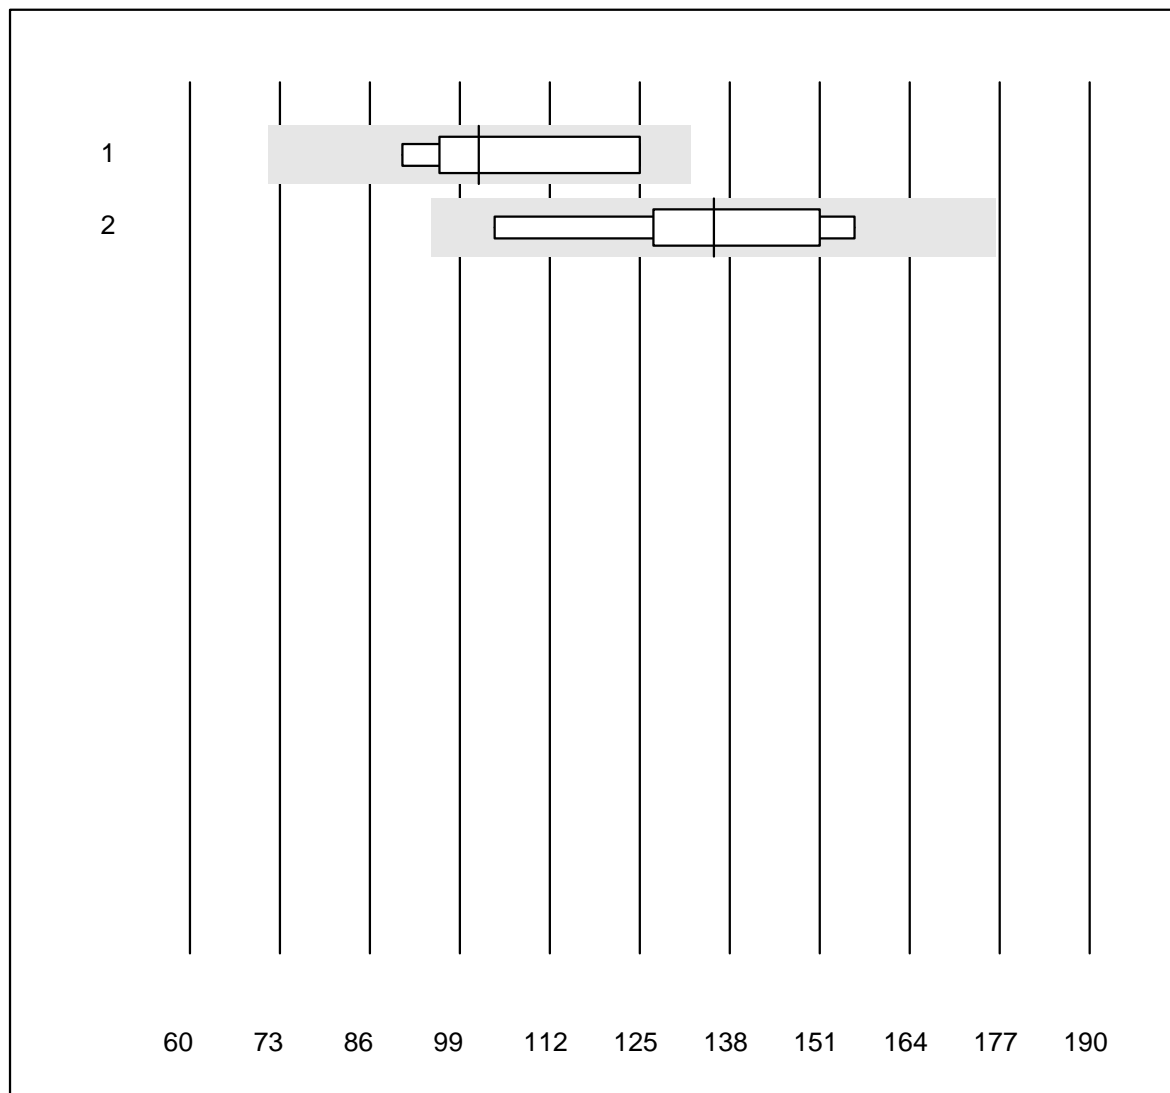


QUALAB Tolérance : 30 %

IgE (kU/L)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	102	14.0	e*
2 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	136	15.4	e*

Alpha-1-Antitrypsine

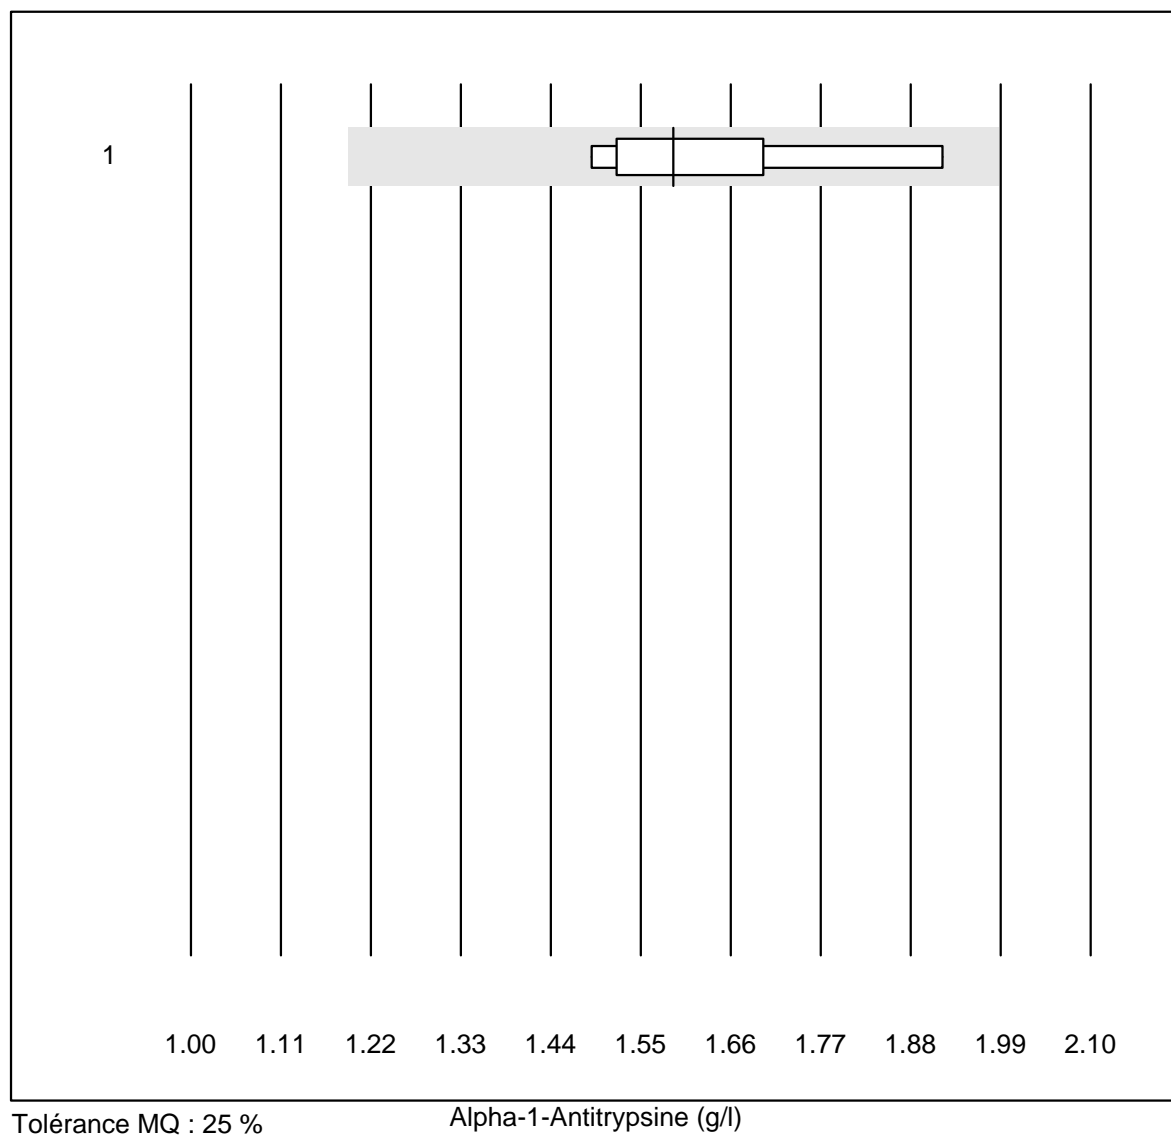

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	1.59	9.0	e*

Anti-Streptolysine-Anticorps

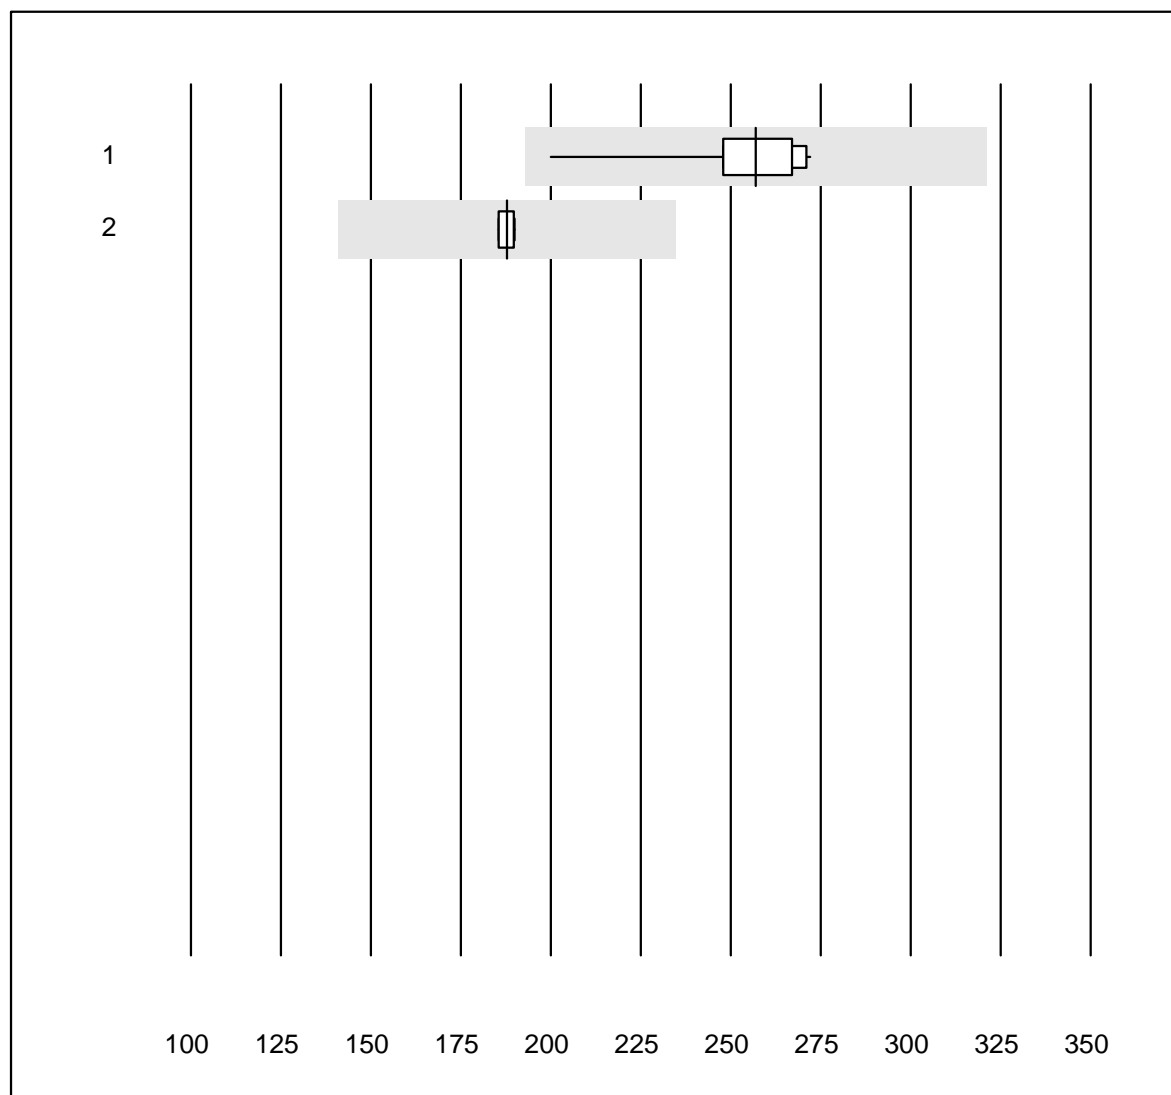


Tolérance MQ : 25 %

Anti-Streptolysine-Anticorps (kIU/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	12	100.0	0.0	0.0	257	7.6	e
2 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	188	1.3	e

Complément C3

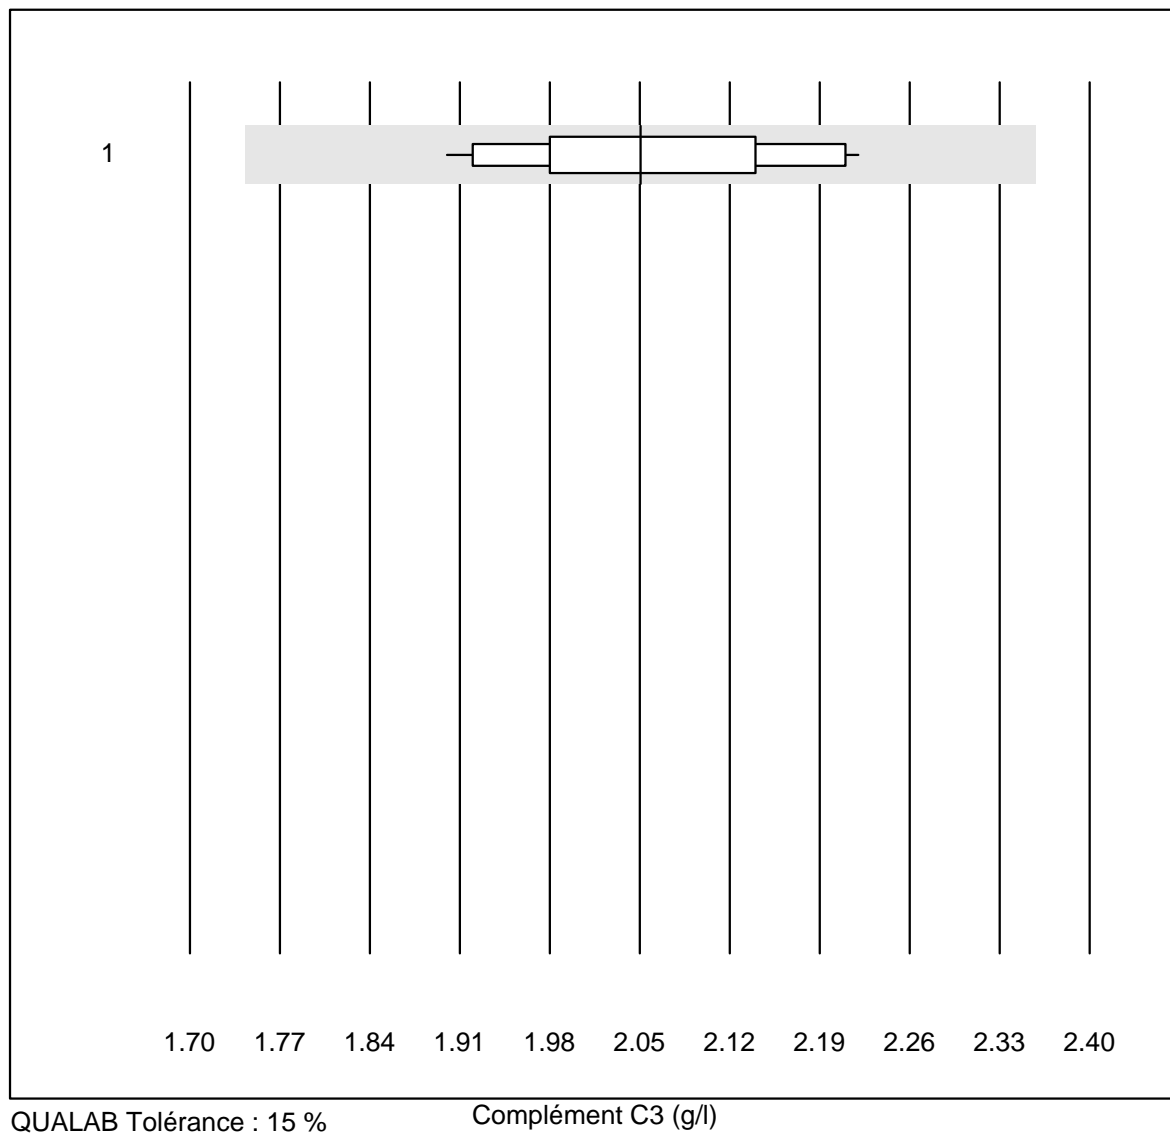


No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	19	100.0	0.0	0.0	2.05	4.7	e

Complément C4

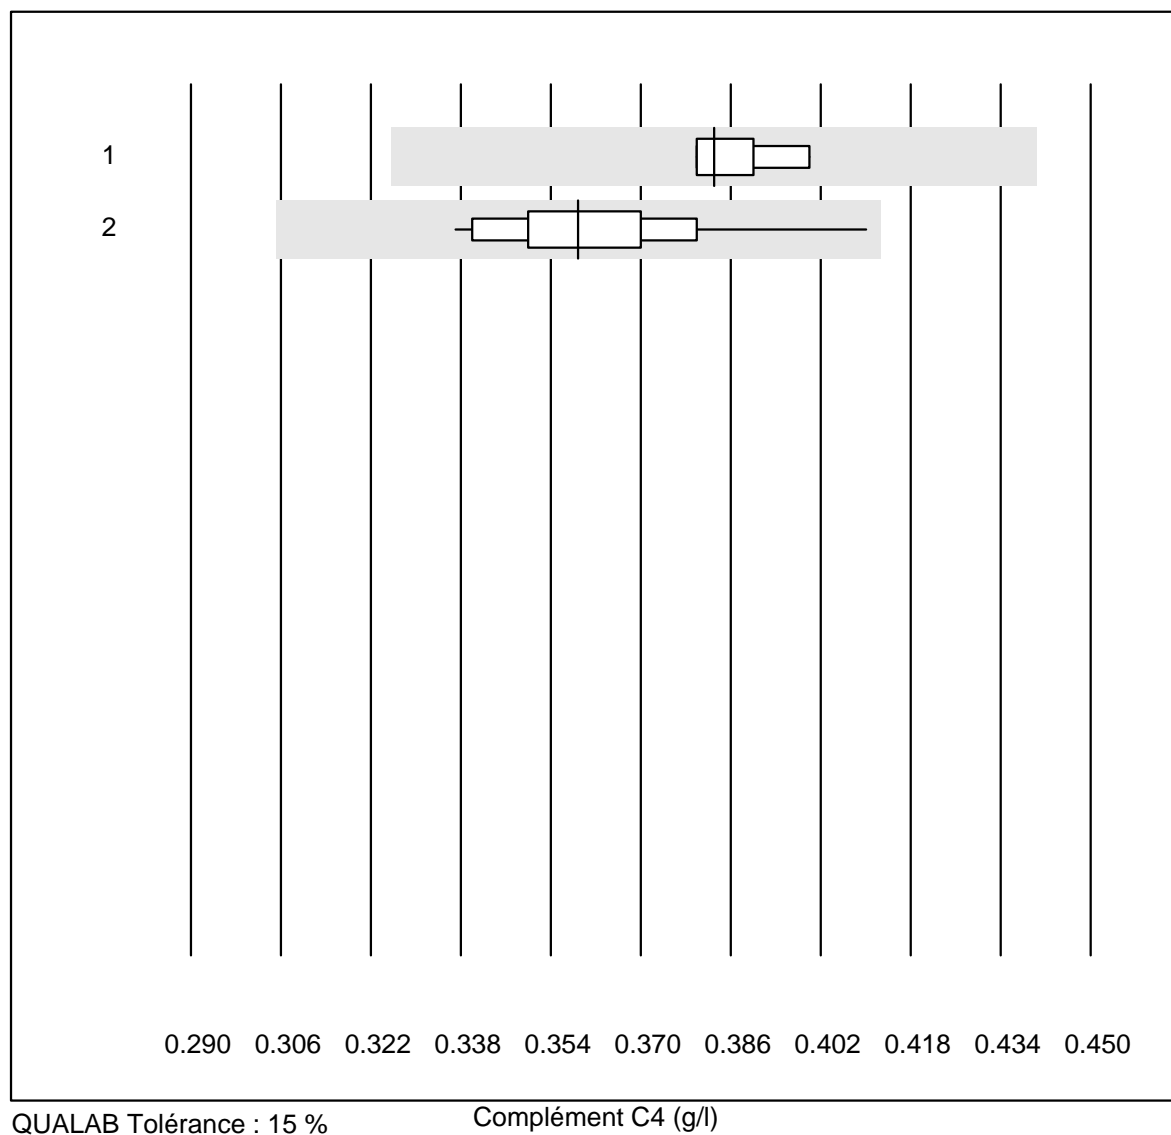


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Alinity	5	100.0	0.0	0.0	0.38	2.2	e
2 toutes les méthodes	13	100.0	0.0	0.0	0.36	5.6	e

Haptoglobine

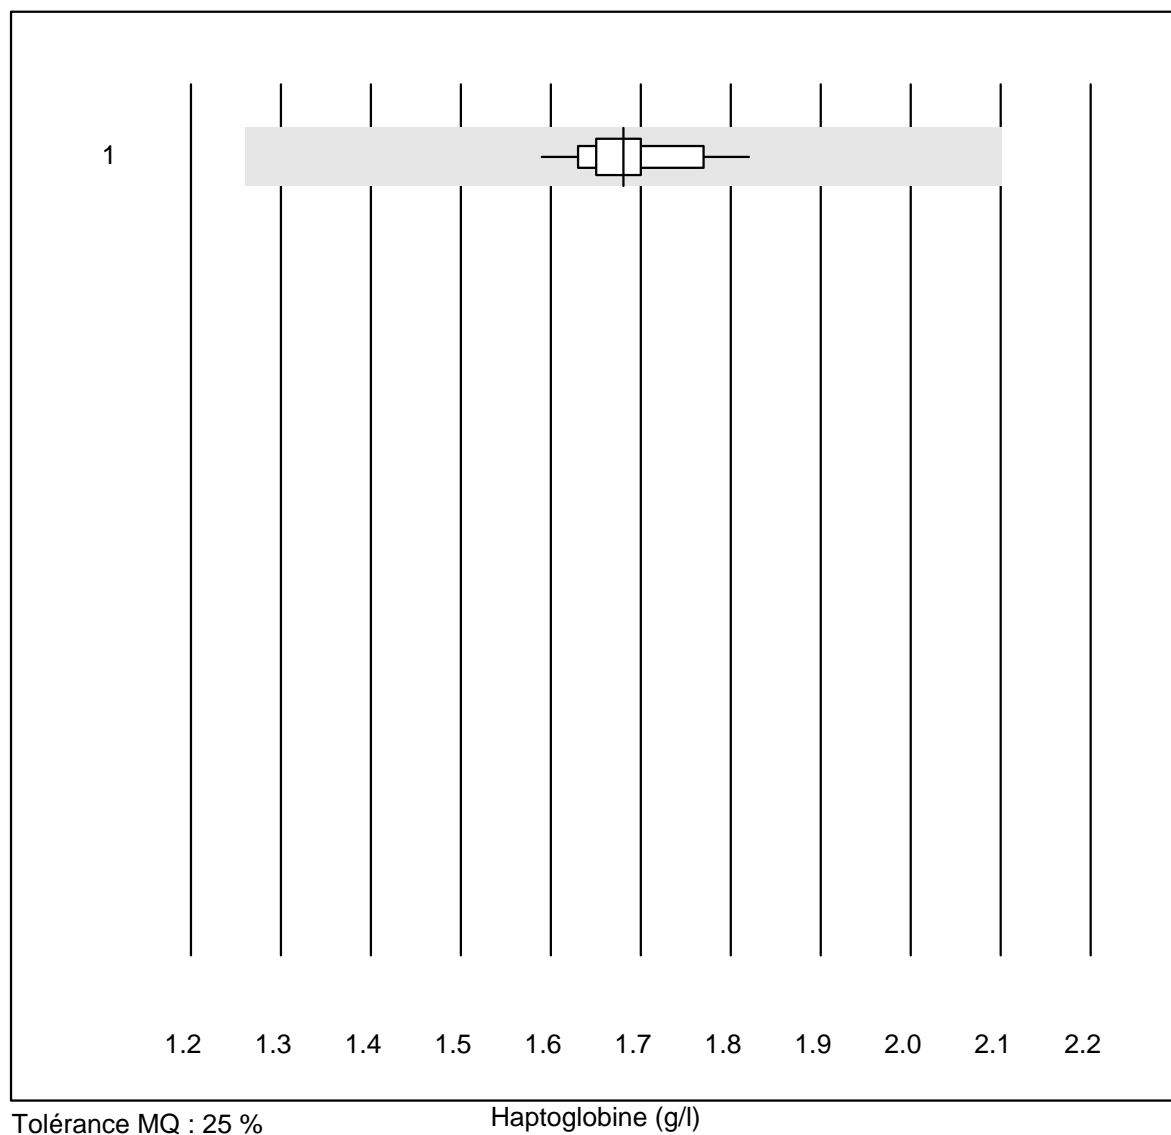

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	24	100.0	0.0	0.0	1.68	3.2	e

Transferrine

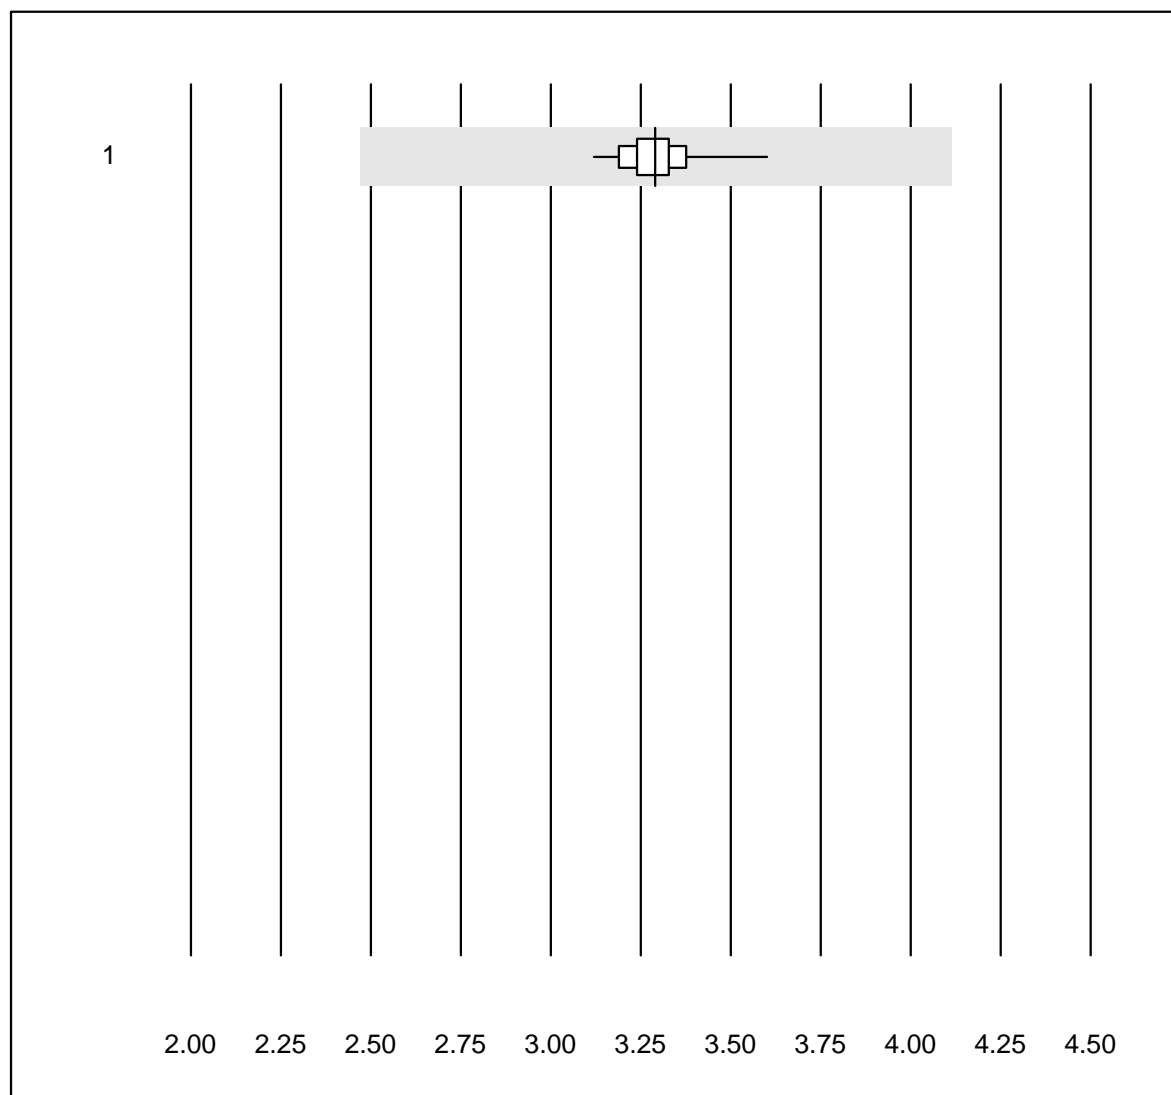


Tolérance MQ : 25 %

Transferrine (g/l)


No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	27	100.0	0.0	0.0	3.29	2.7	e

Bêta-2 microglobuline

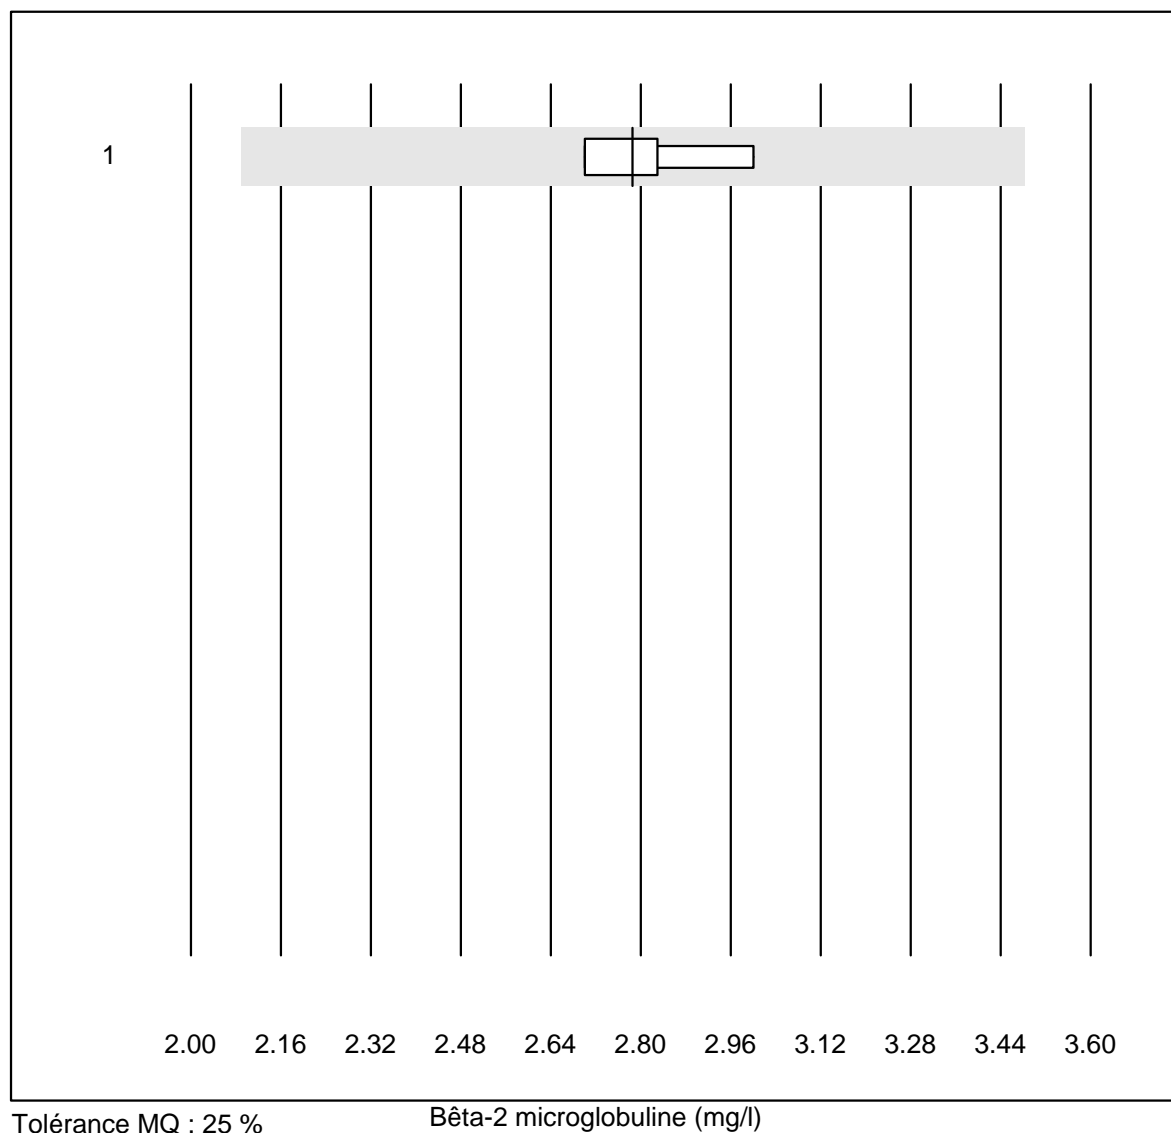

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	8	100.0	0.0	0.0	2.79	3.7	e

Facteur rhumatoïde

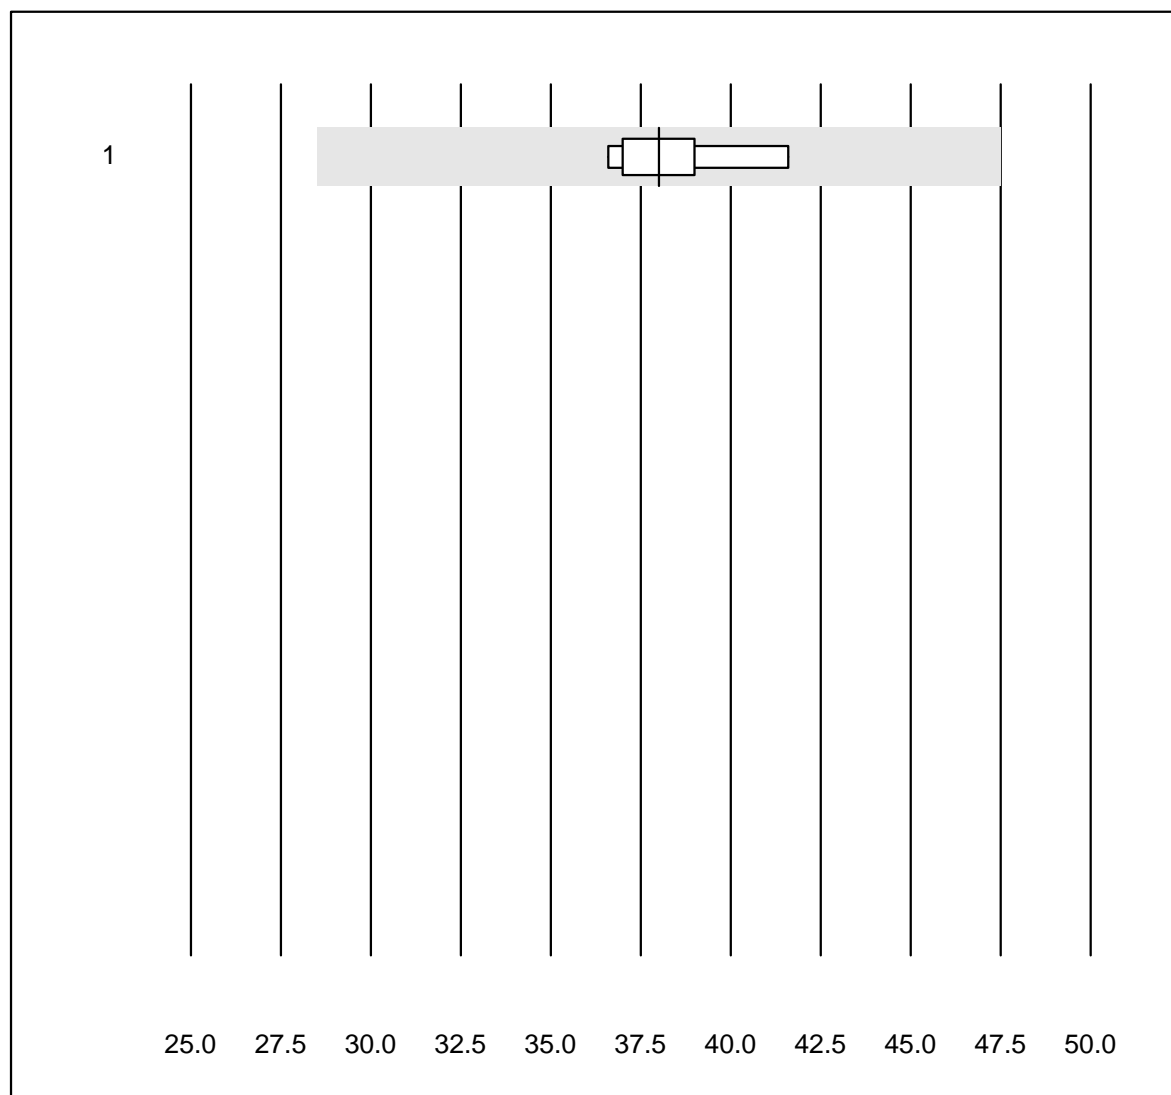


Tolérance MQ : 25 %

Facteur rhumatoïde (U/ml)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Architect	5	100.0	0.0	0.0	38.0	5.2	e

Céruleoplasmine

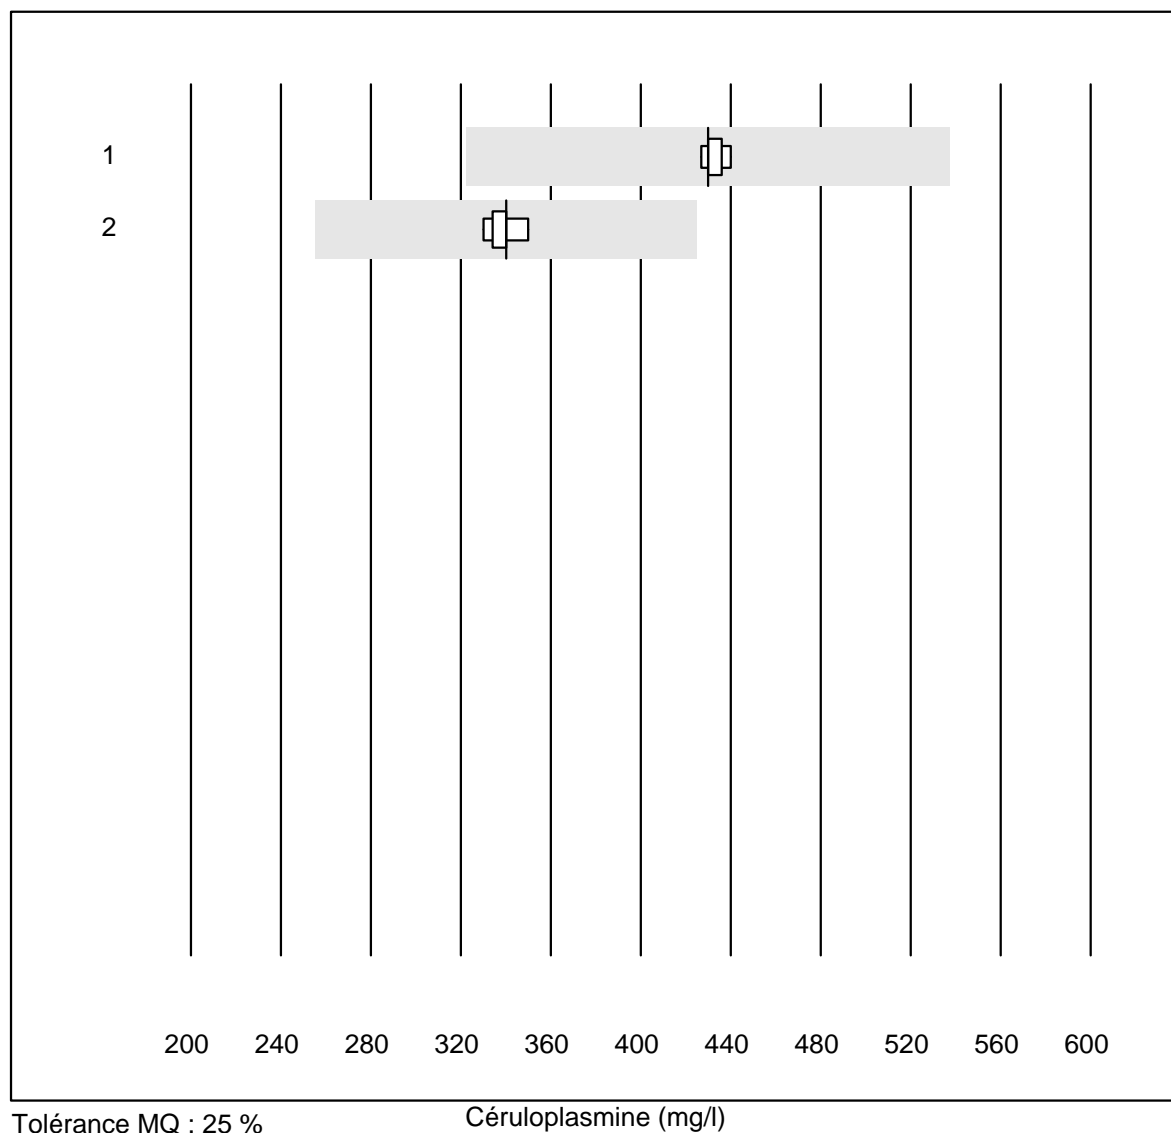


Tolérance MQ : 25 %

Céruleoplasmine (mg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Siemens	5	100.0	0.0	0.0	430.00	1.2	e
2 toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	340.00	2.2	e

Pré-albumine

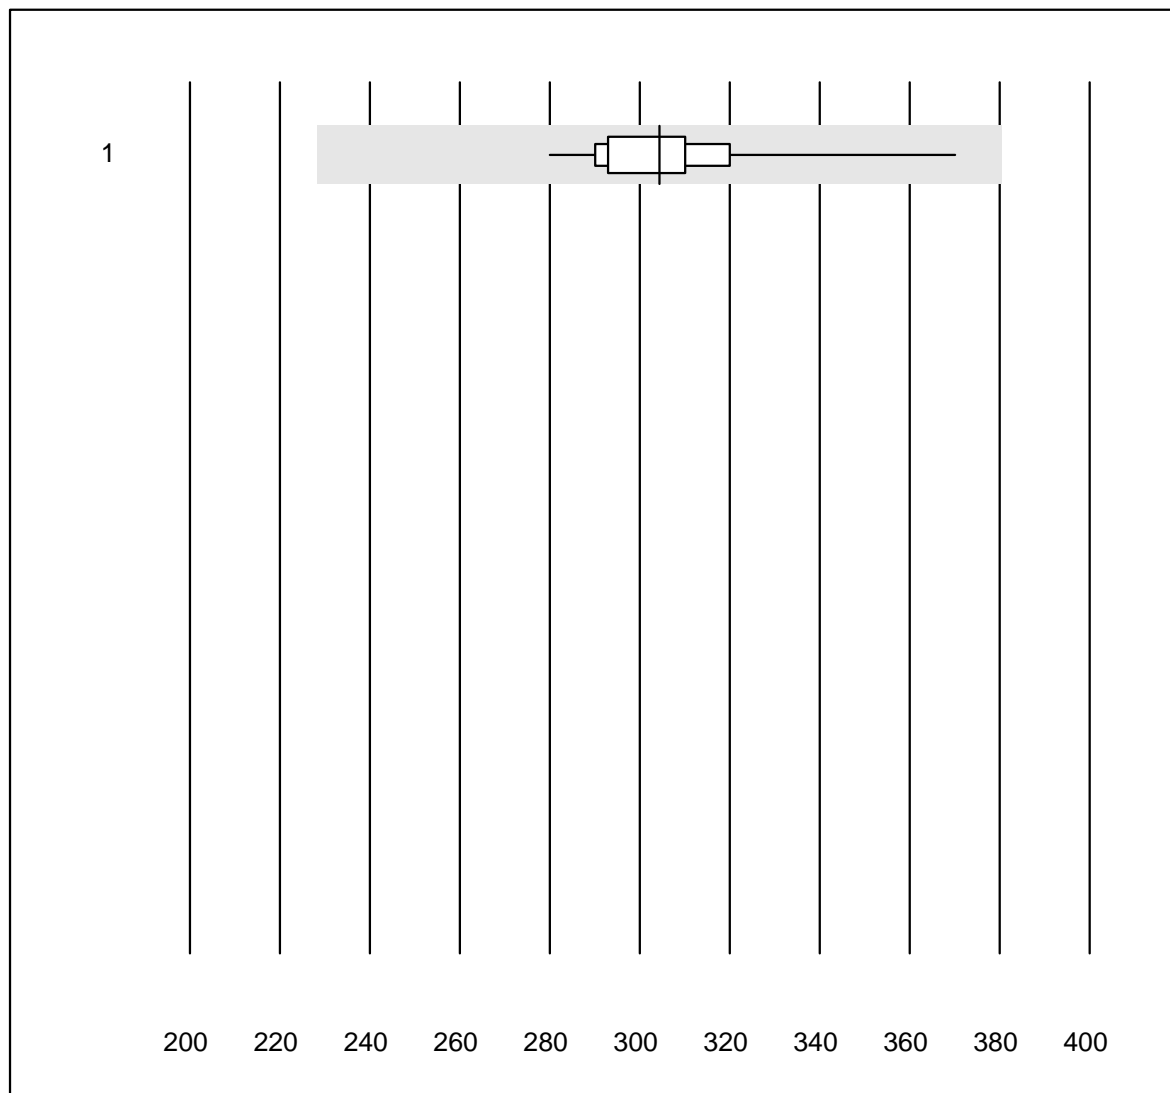


Tolérance MQ : 25 %

Pré-albumine (mg/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	17	100.0	0.0	0.0	304.4	6.5	e

Récepteur soluble de la transferrine

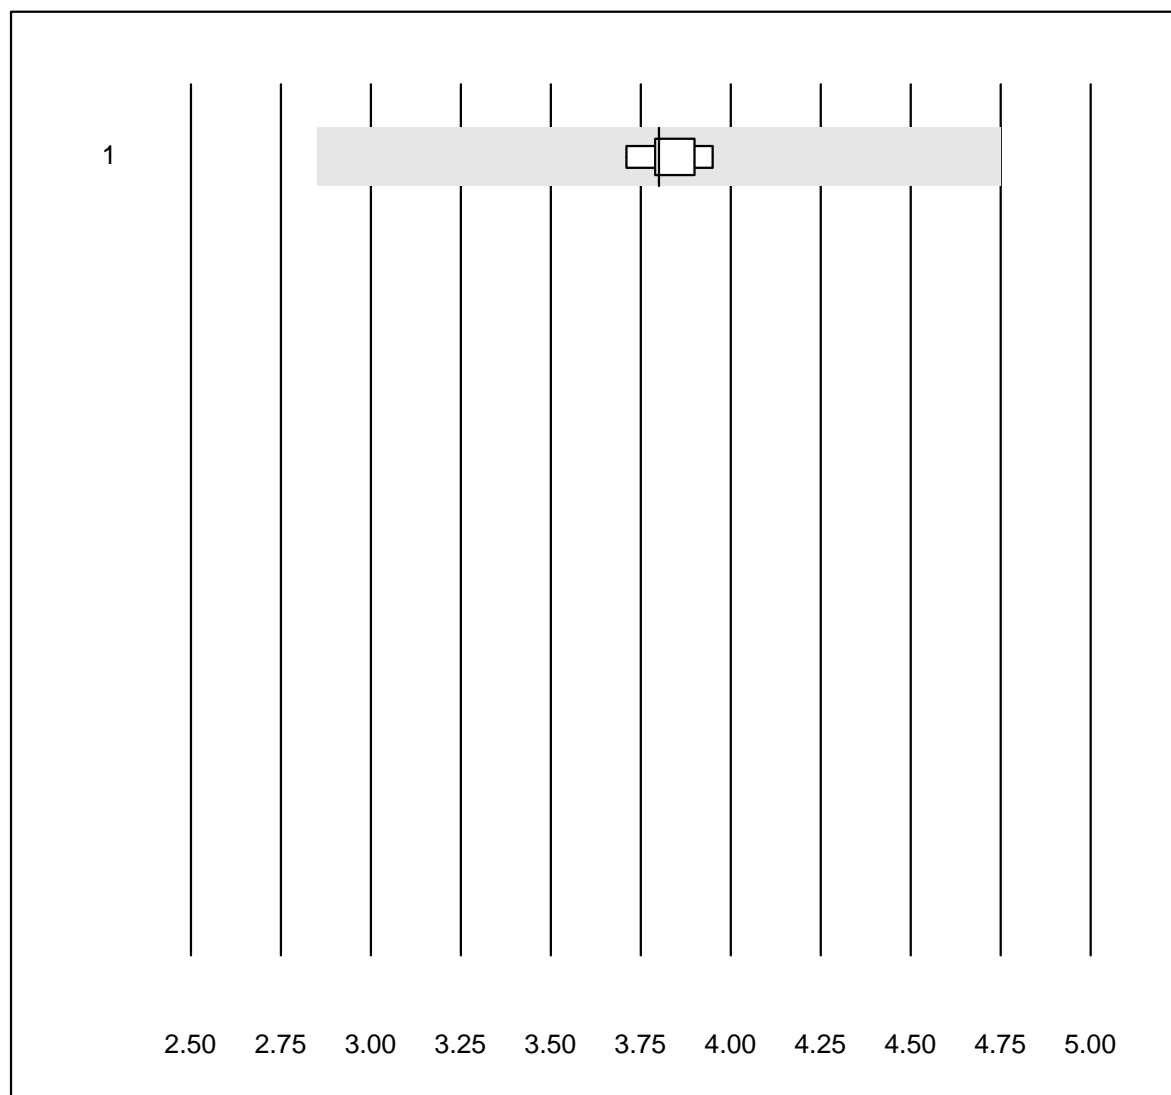


Tolérance MQ : 25 %

Récepteur soluble de la transferrine (mg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	3.8	2.1	e


chaînes légères libres Kappa

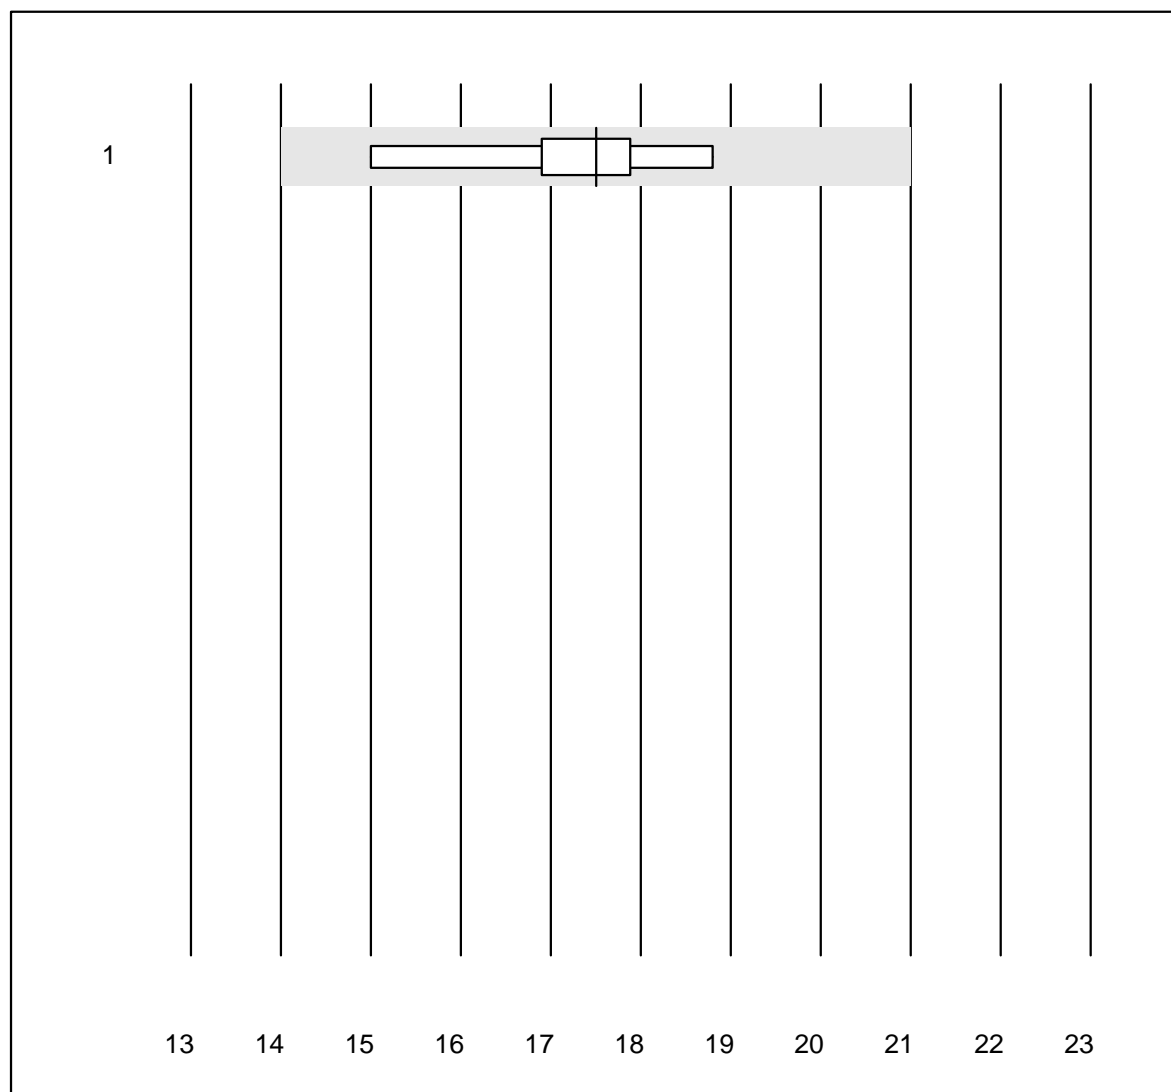

QUALAB Tolérance : 20 % chaînes légères libres Kappa (mg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	9	88.9	0.0	11.1	18	6.5	e

chaîne légère Lambda

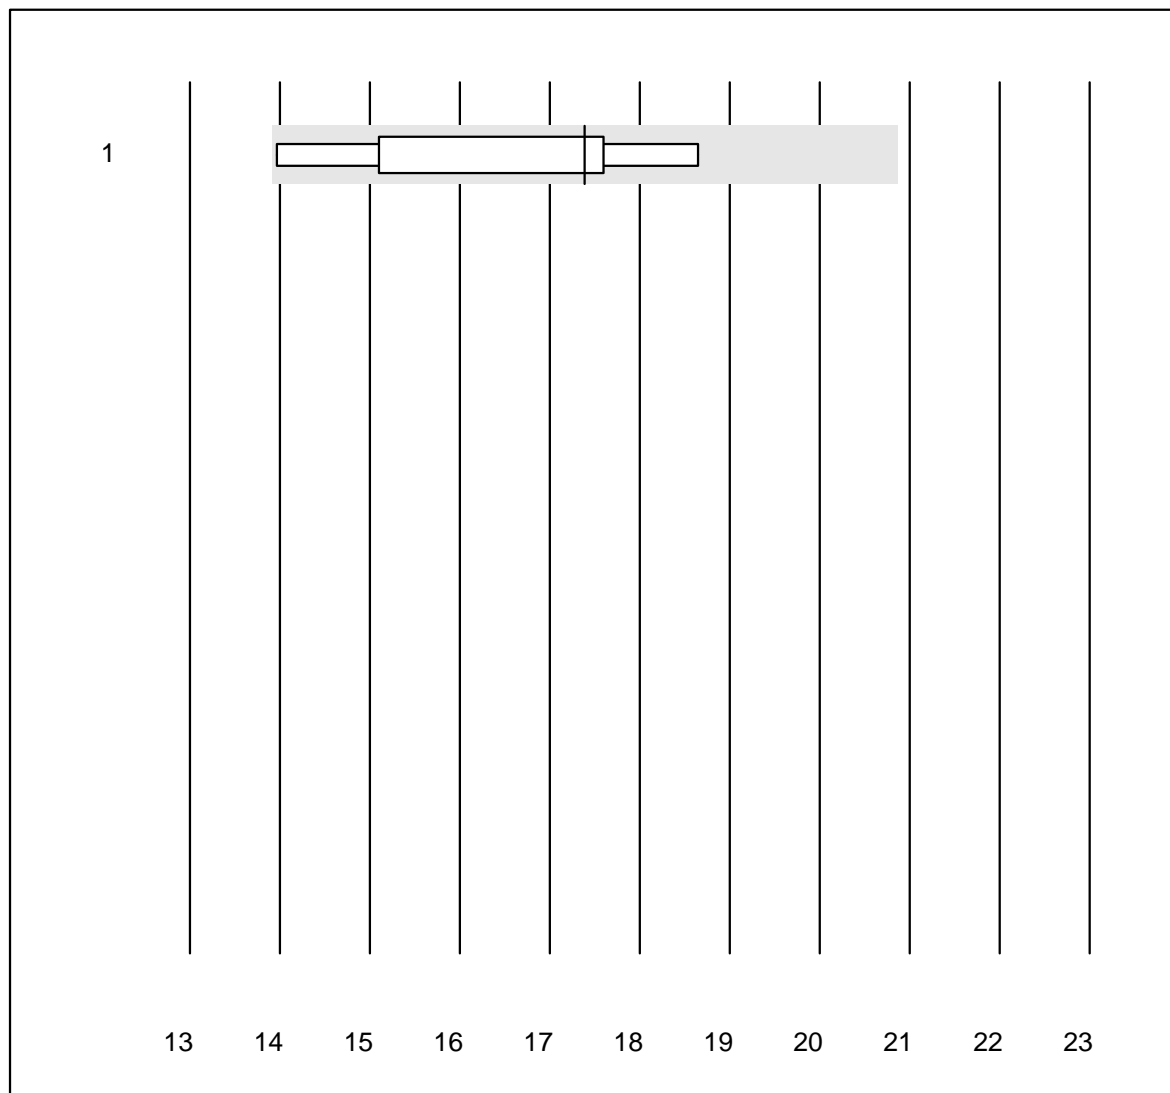


QUALAB Tolérance : 20 %

chaîne légère Lambda (mg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	9	88.9	0.0	11.1	17	9.2	e*

IgE arachides qn

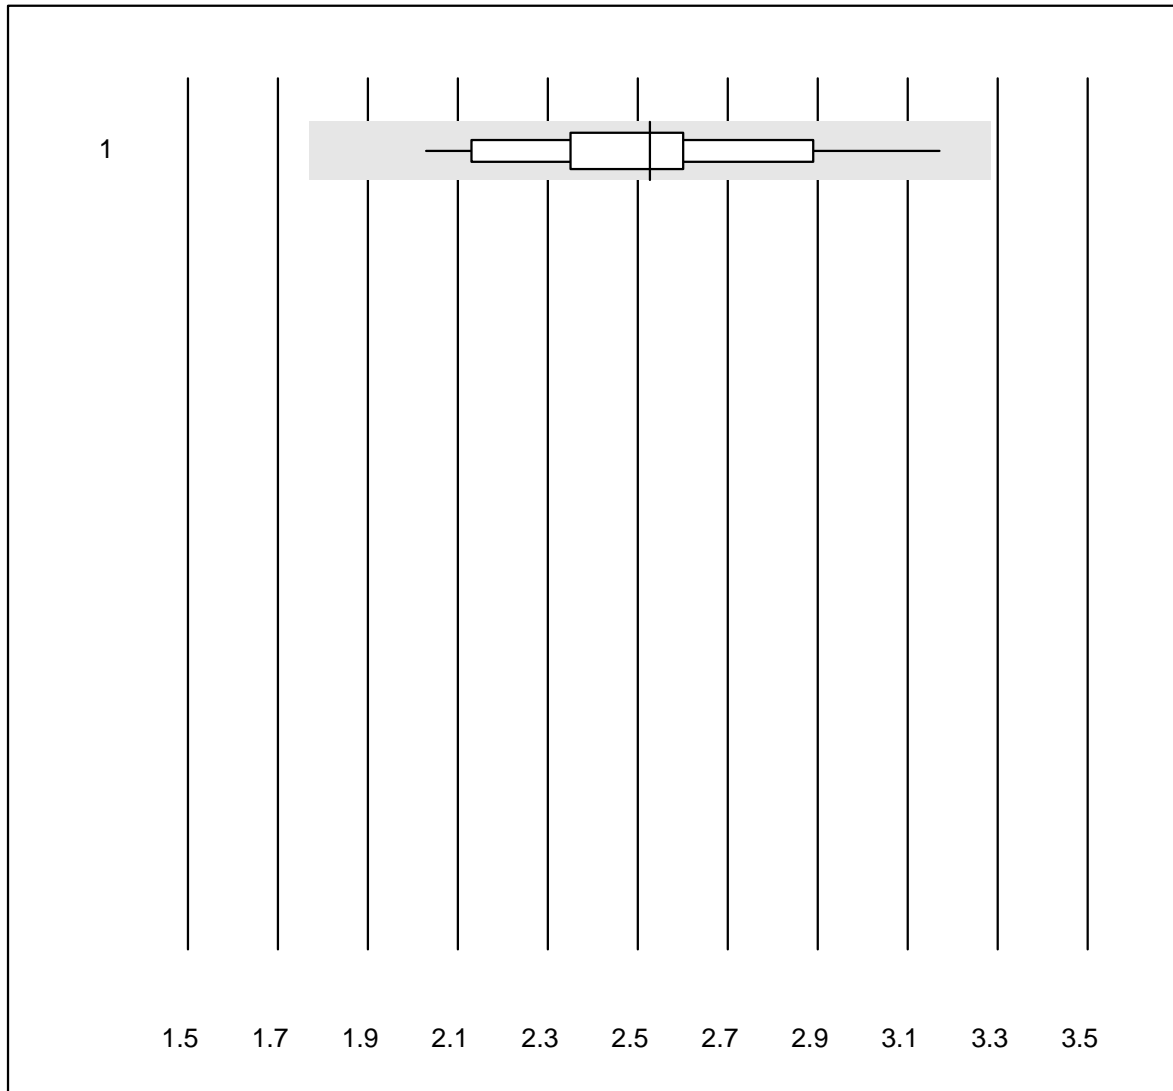


Tolérance MQ : 30 %

IgE arachides qn (kU/L)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	toutes les méthodes	13	100.0	0.0	0.0	3	11.8	e

IgE bouleau qn

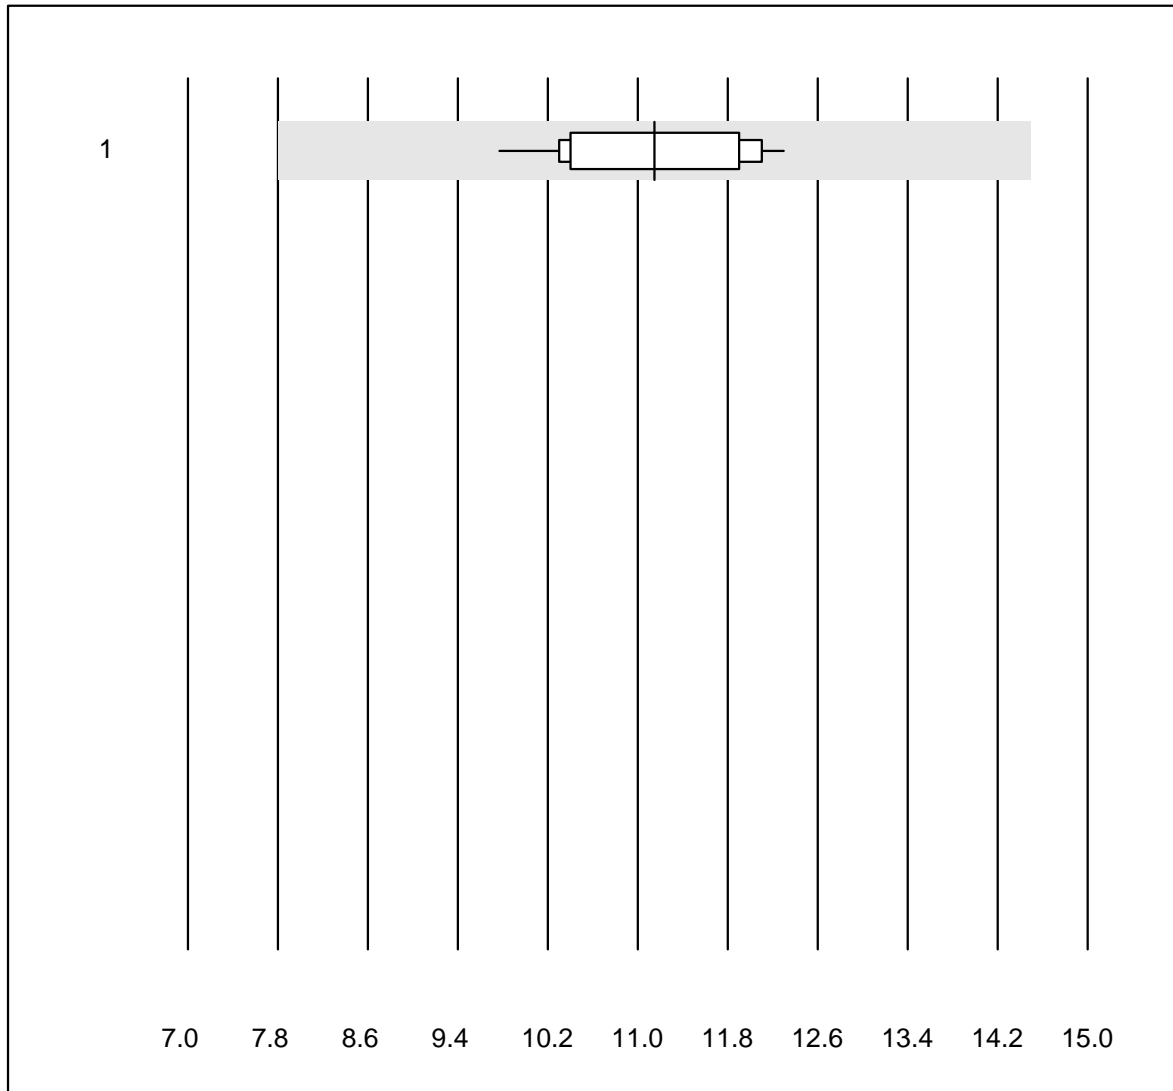


QUALAB Tolérance : 30 %

IgE bouleau qn (kU/L)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	12	100.0	0.0	0.0	11	7.3	e


IgE épithélium du chat qn

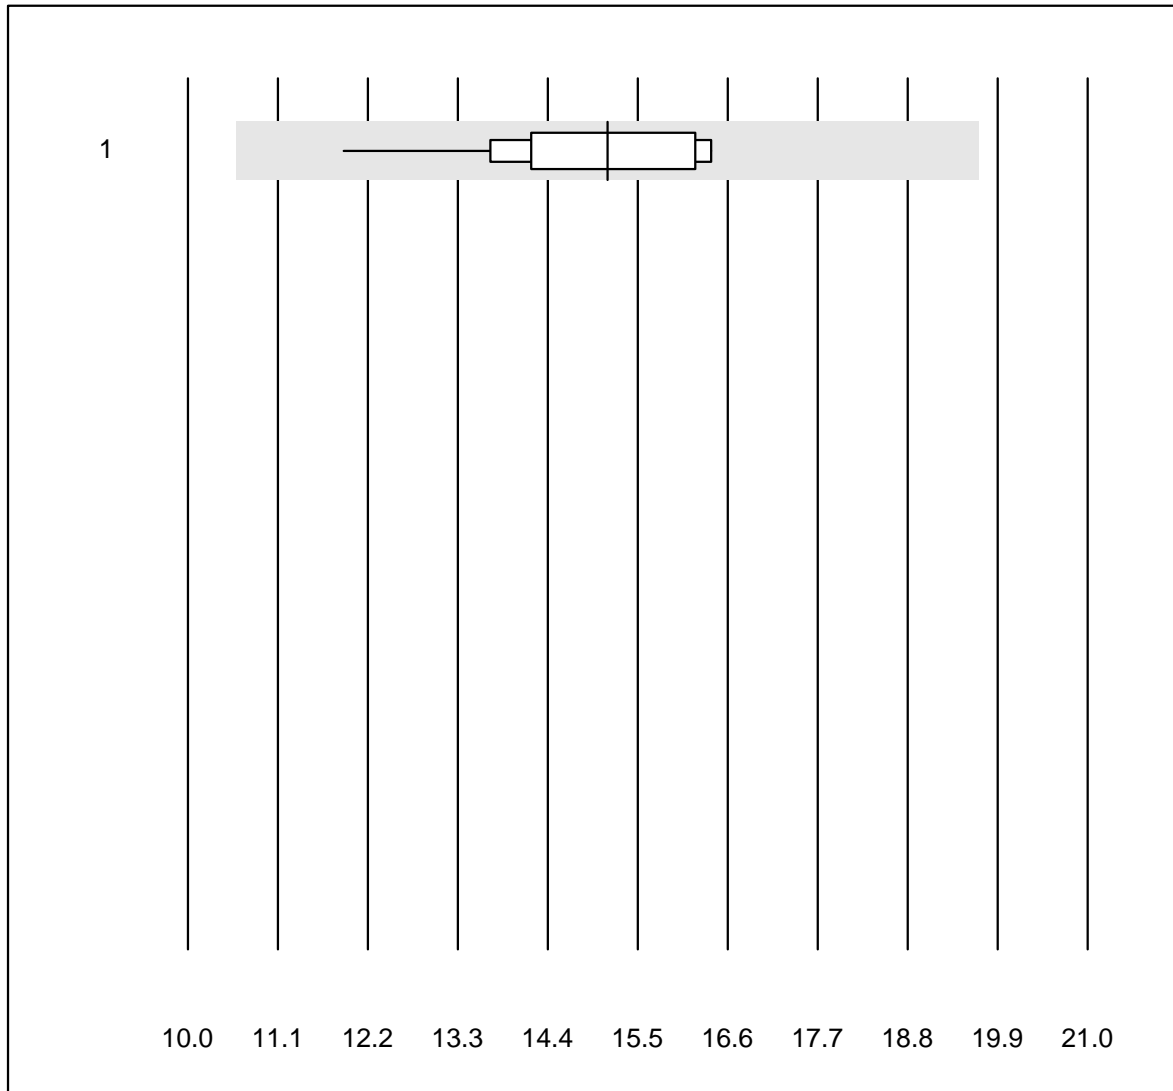

QUALAB Tolérance : 30 % IgE épithélium du chat qn (kU/L)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	toutes les méthodes	12	100.0	0.0	0.0	15	8.9	e

IgE totale

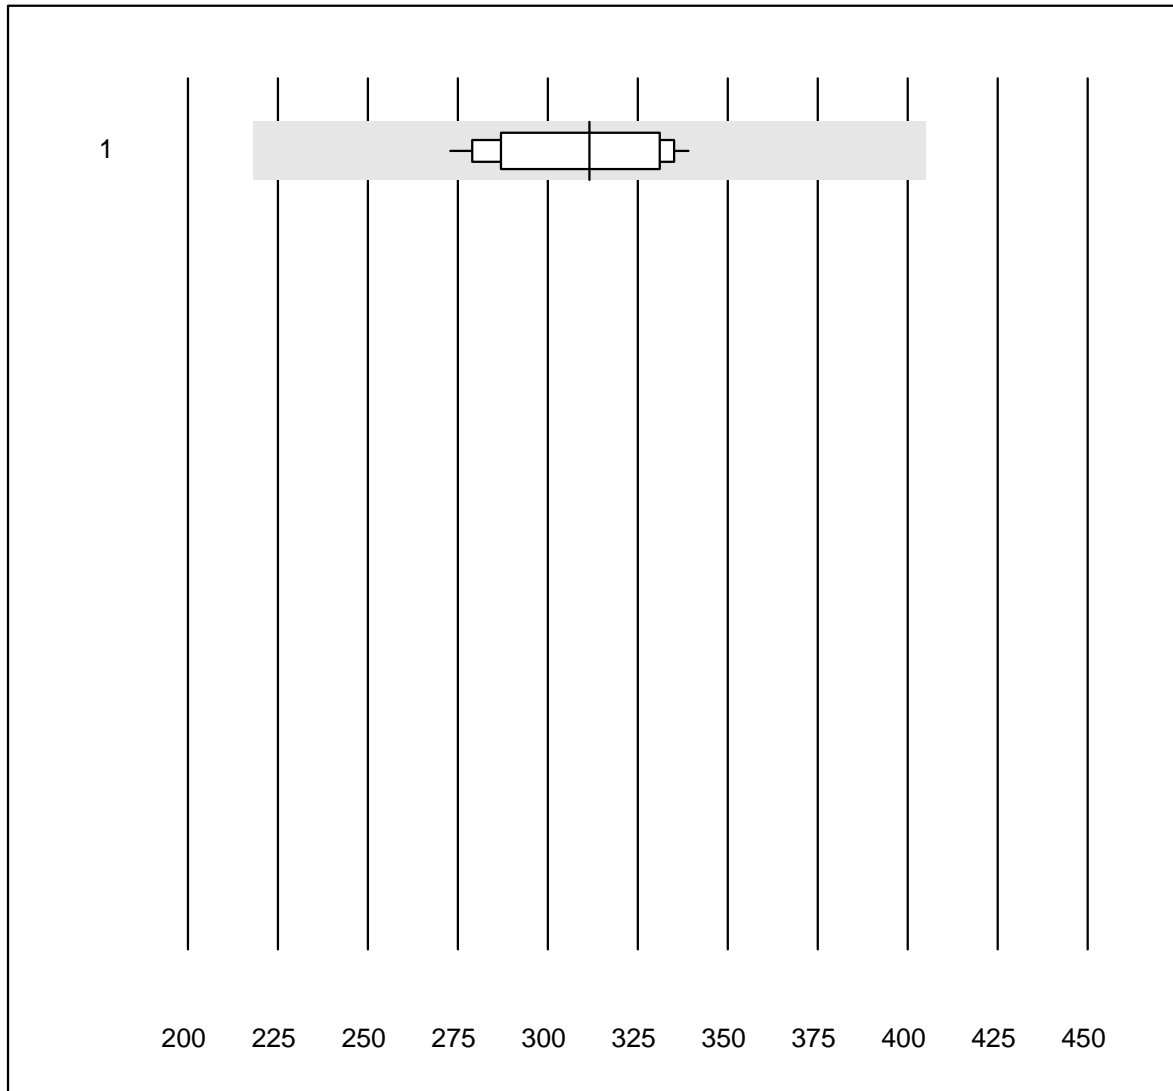


QUALAB Tolérance : 30 %

IgE totale (kU/L)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	toutes les méthodes	12	100.0	0.0	0.0	312	7.7	e

IgE sx1 qn

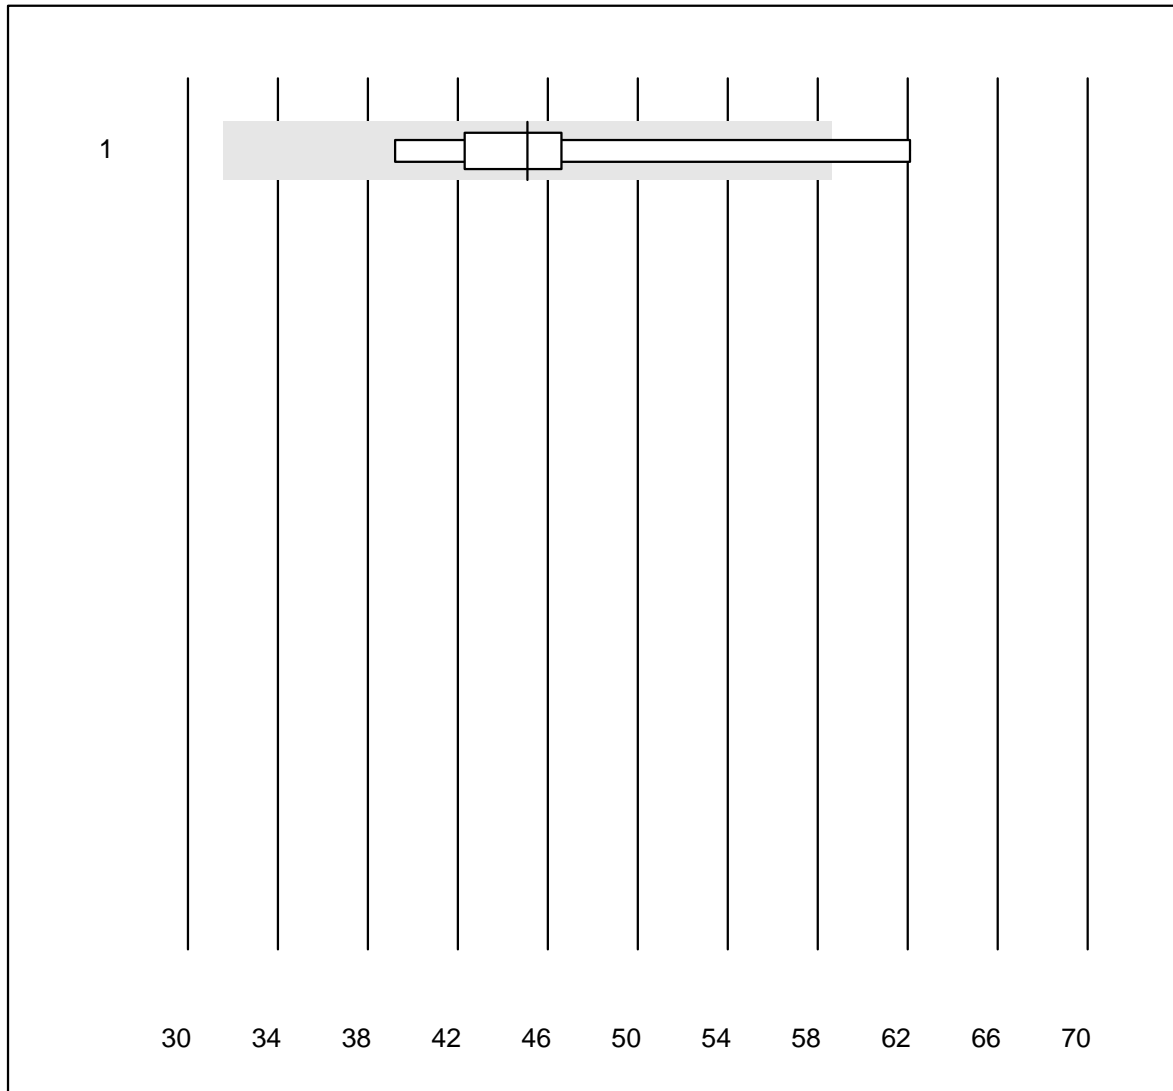


QUALAB Tolérance : 30 %

IgE sx1 qn (kU/L)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	toutes les méthodes	9	88.9	11.1	0.0	45	14.7	e*

IgE fx5 qn

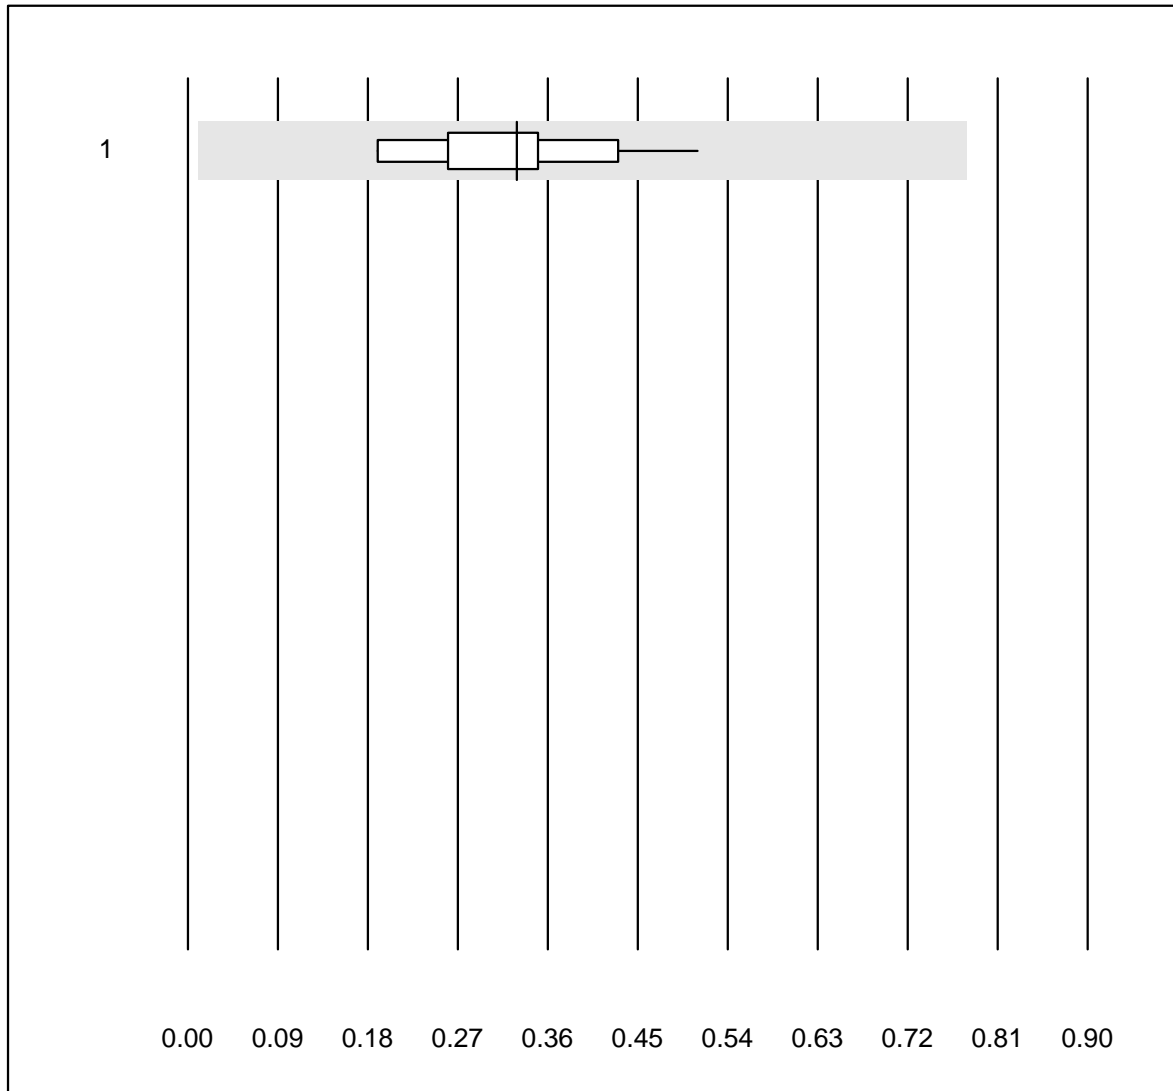


QUALAB Tolérance : 30 %
(< 2: +/- 0 kU/L)

IgE fx5 qn (kU/L)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	toutes les méthodes	10	100.0	0.0	0.0	0	27.4	e*

IgE rx1qn

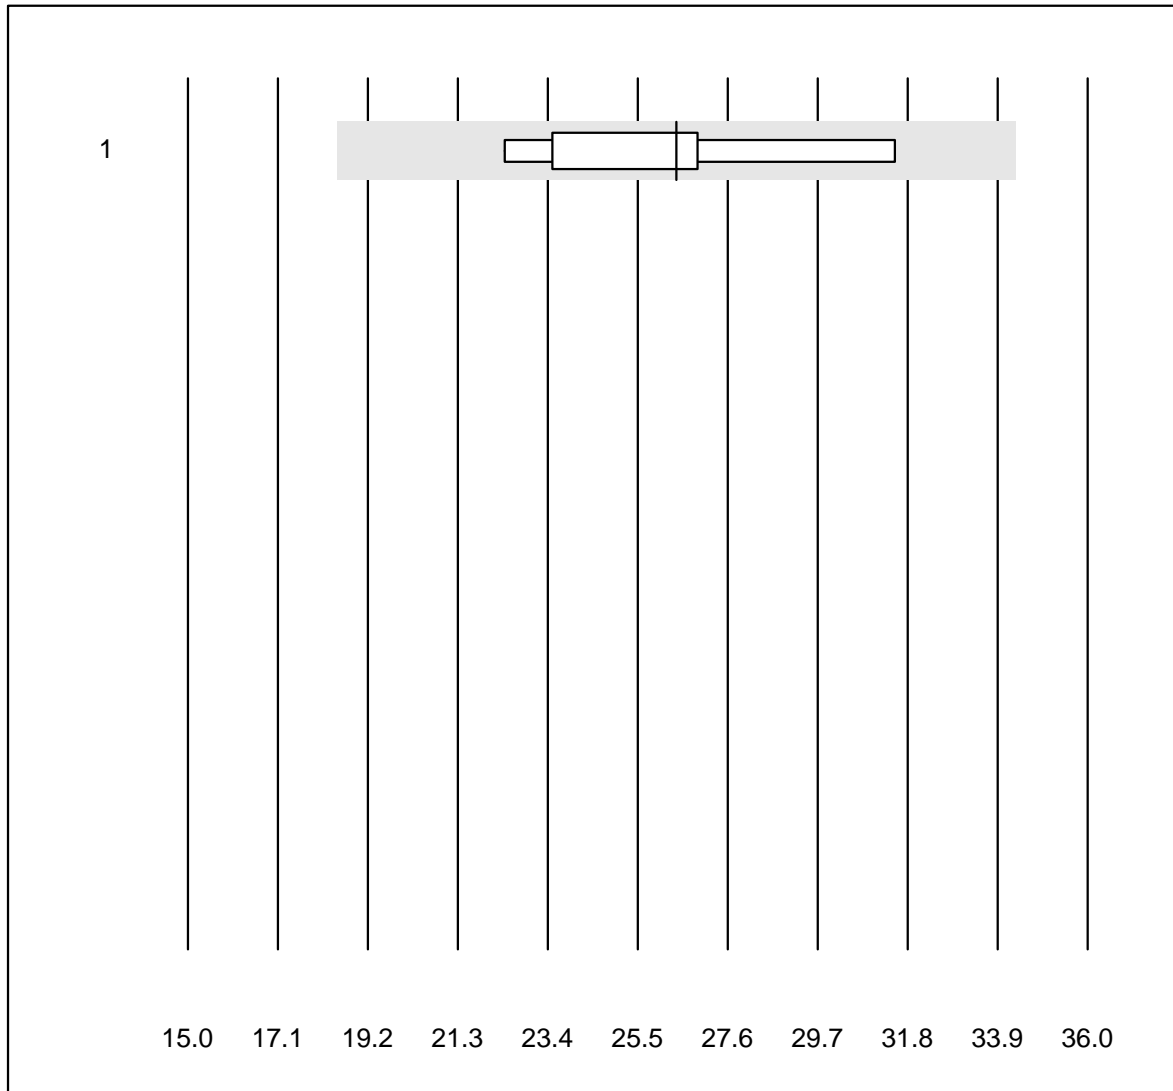


QUALAB Tolérance : 30 %

IgE rx1qn (kU/L)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	8	100.0	0.0	0.0	26	11.2	e*

IgE rx2 qn

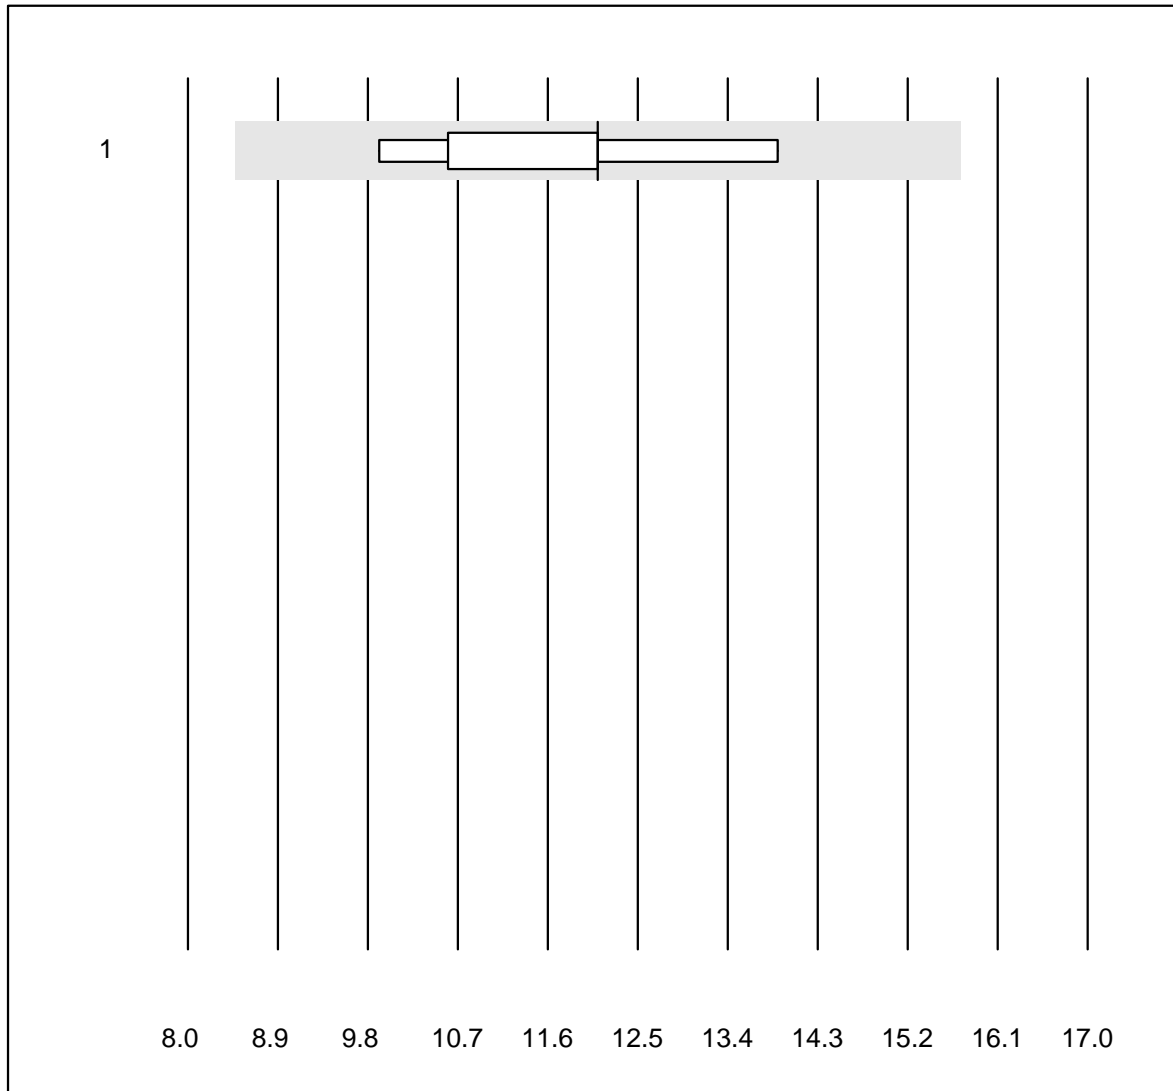


QUALAB Tolérance : 30 %

IgE rx2 qn (kU/L)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	toutes les méthodes	8	100.0	0.0	0.0	12	11.3	e*


IgE D. pteronyssinus qn

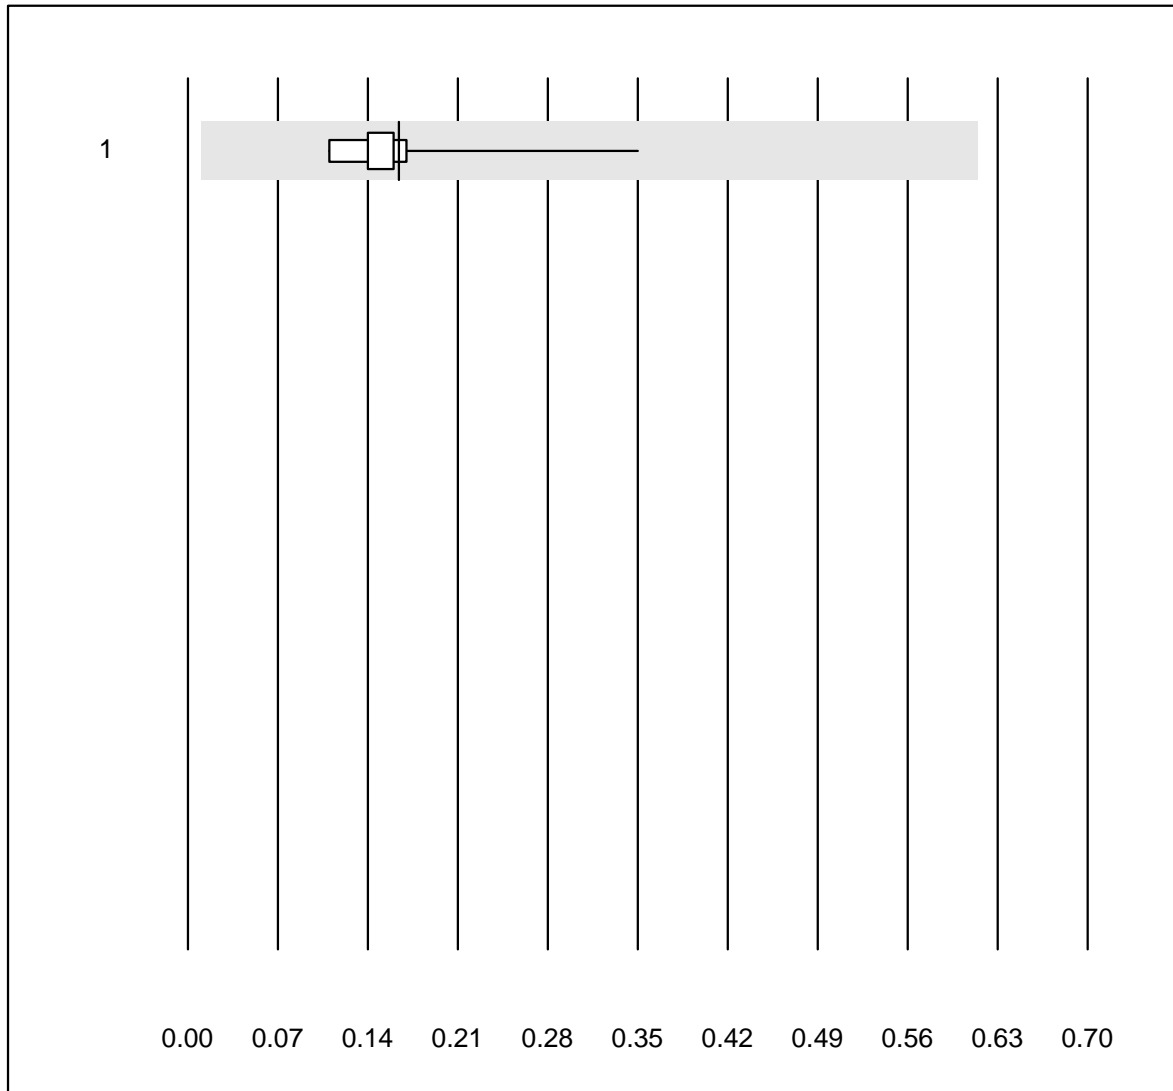

QUALAB Tolérance : 30 %
 (< 2: +/- 0 kU/L) IgE D. pteronyssinus qn (kU/L)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	toutes les méthodes	10	100.0	0.0	0.0	0	41.4	e*

CRP HS

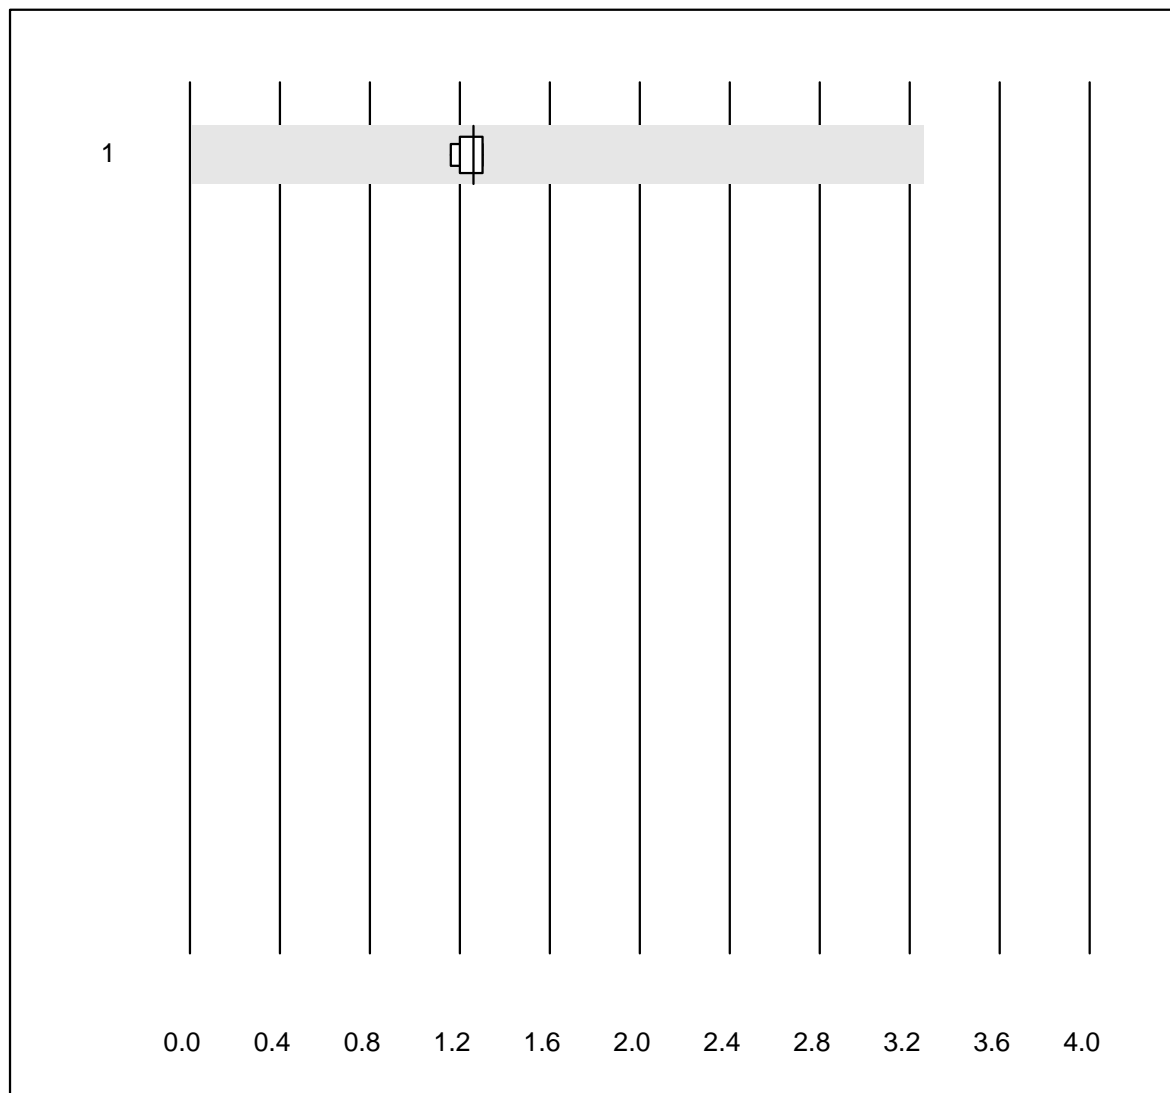


QUALAB Tolérance : 21 %
 (< 10.00: +/- 2.00 mg/l)

CRP HS (mg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Turbidimetrie	8	100.0	0.0	0.0	1.26	4.4	e

Lipoprotein (a)

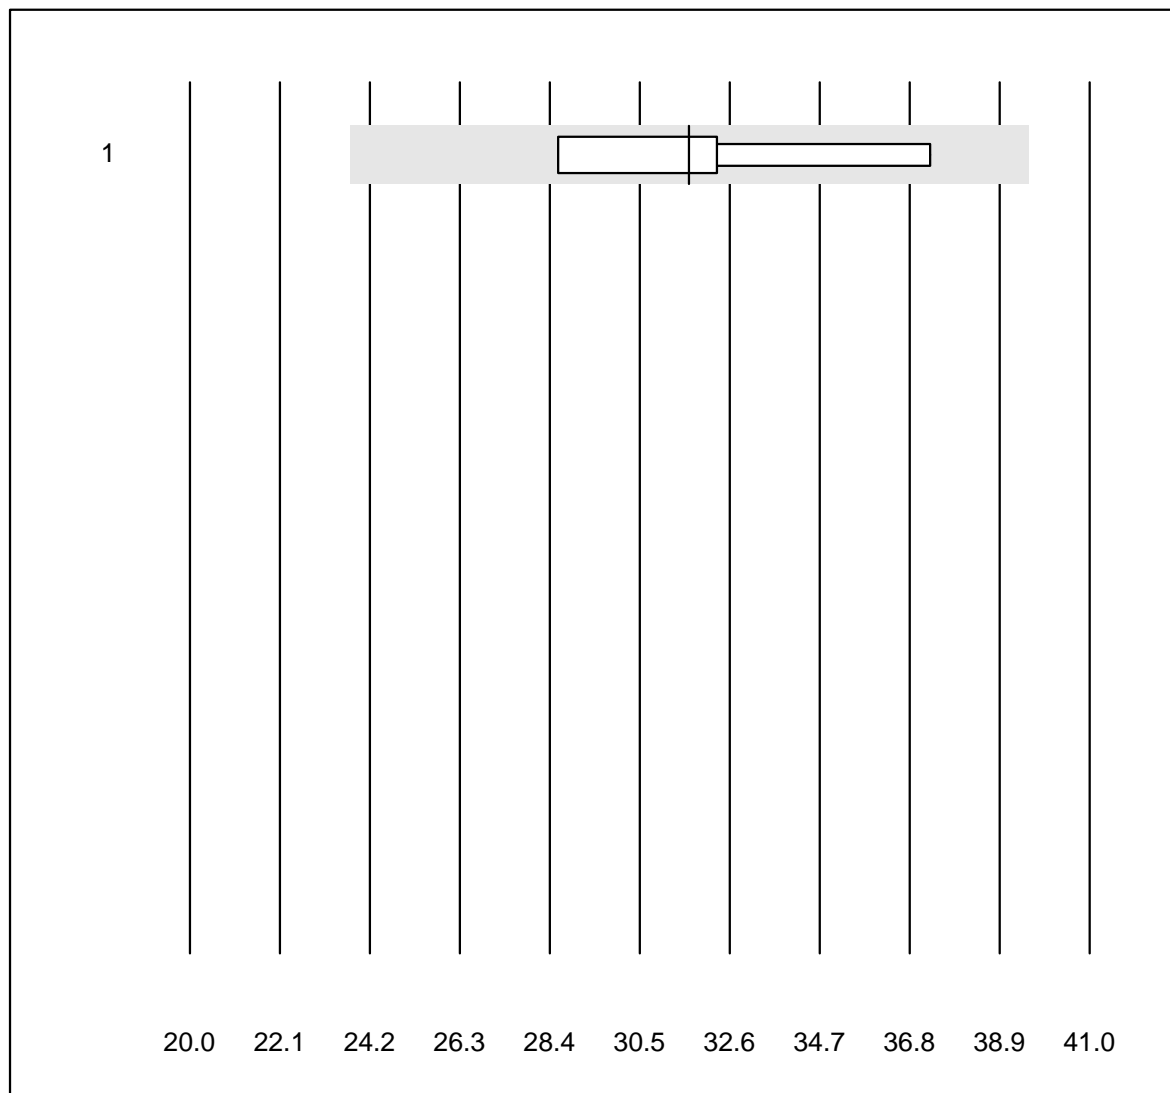


Tolérance MQ : 25 %

Lipoprotein (a) (nmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	32	11.3	e*


CRP

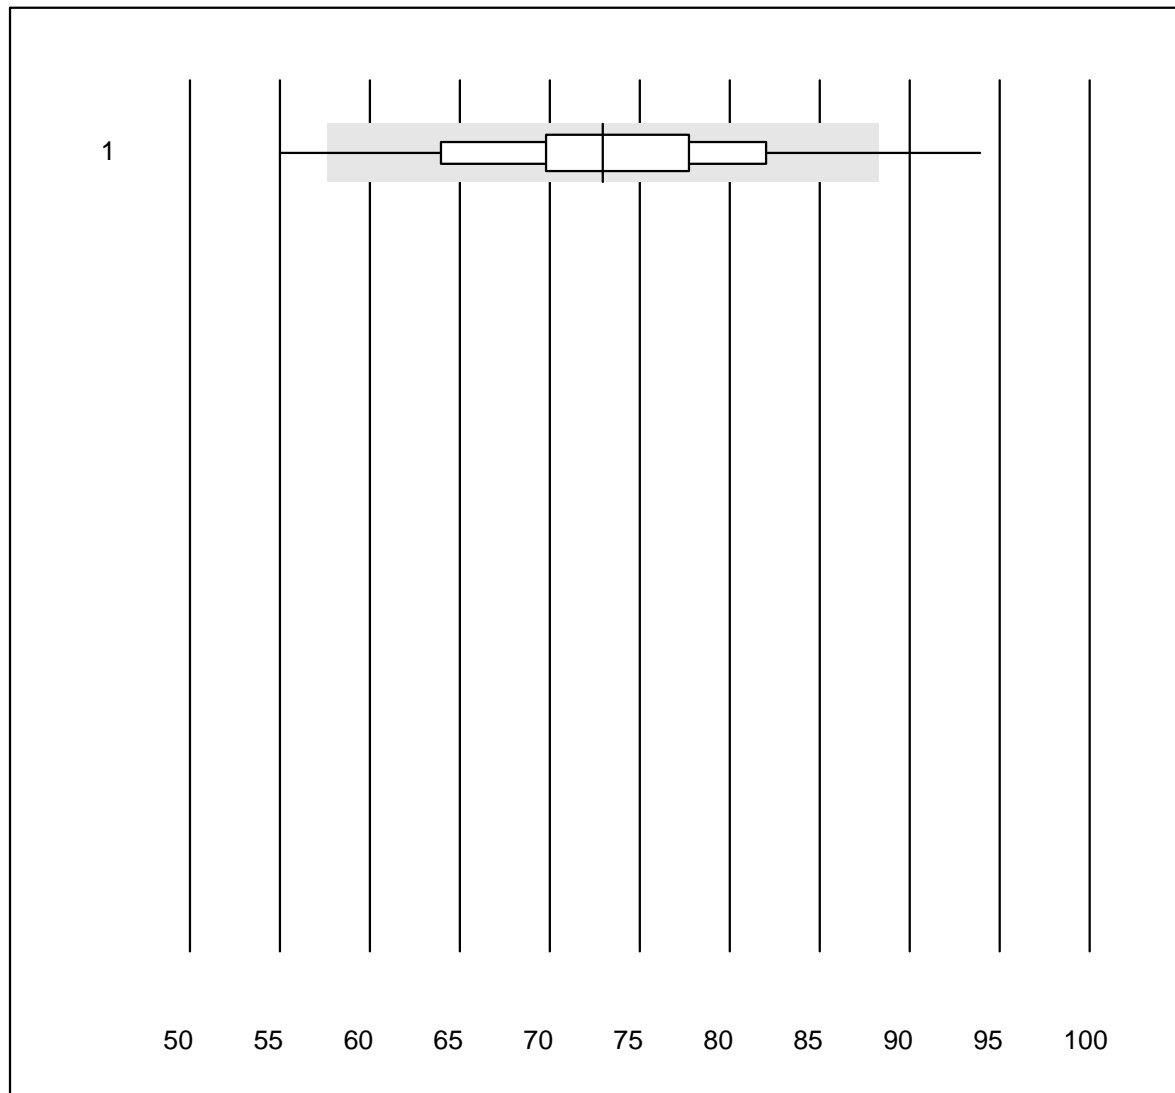

QUALAB Tolérance : 21 % CRP (mg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 AFIAS	130	90.8	3.8	5.4	73.0	9.9	e

Anti tTG IgA

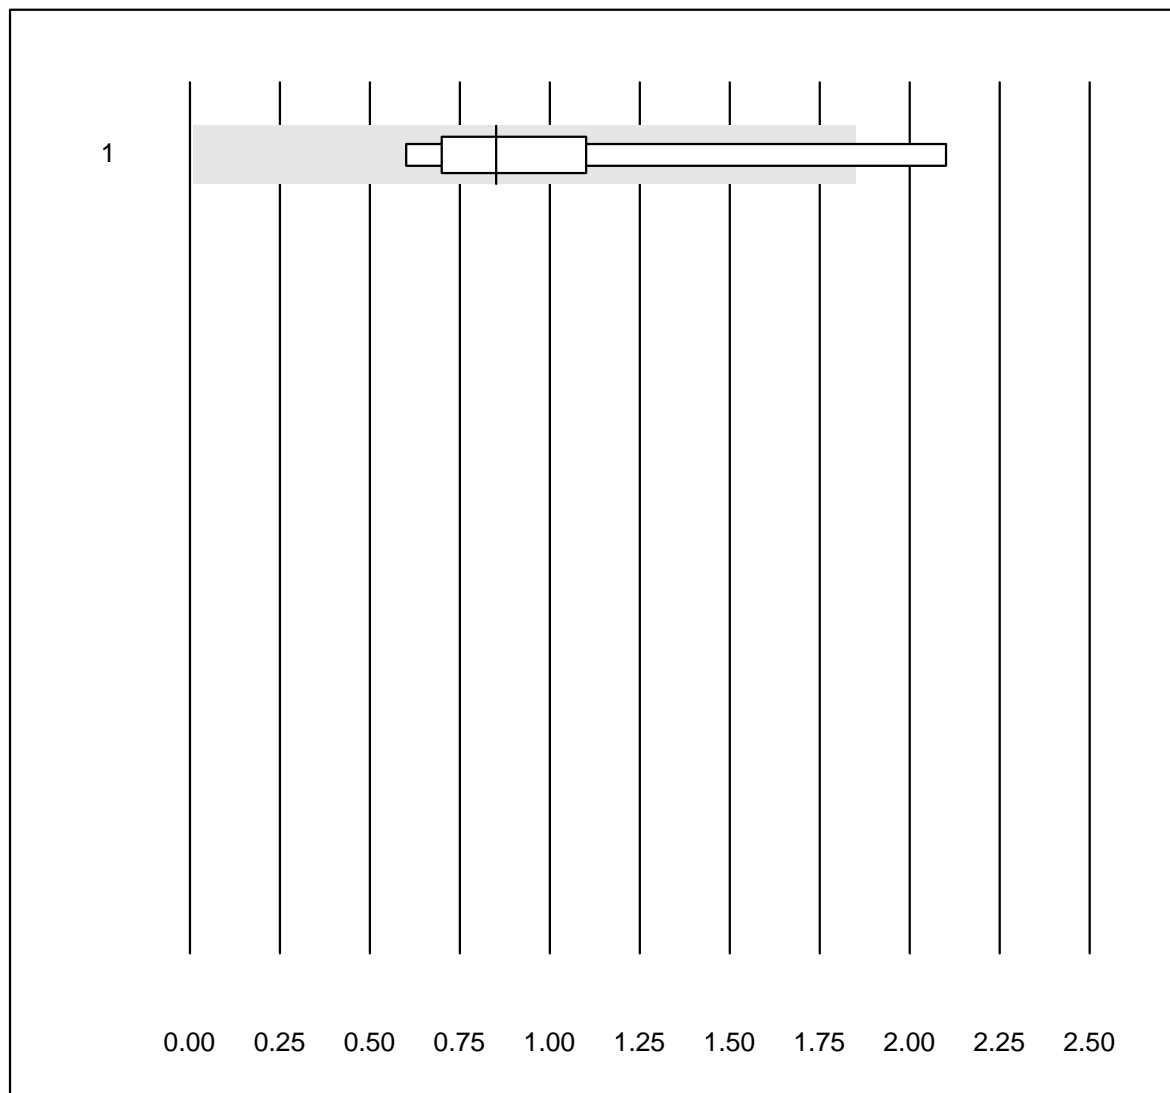


Tolérance MQ : 30 %
 (< 2.00: +/- 1.00 U/ml)

Anti tTG IgA (U/ml)


No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Autres méthodes	6	83.3	16.7	0.0	0.85	53.9	e*

Albumine

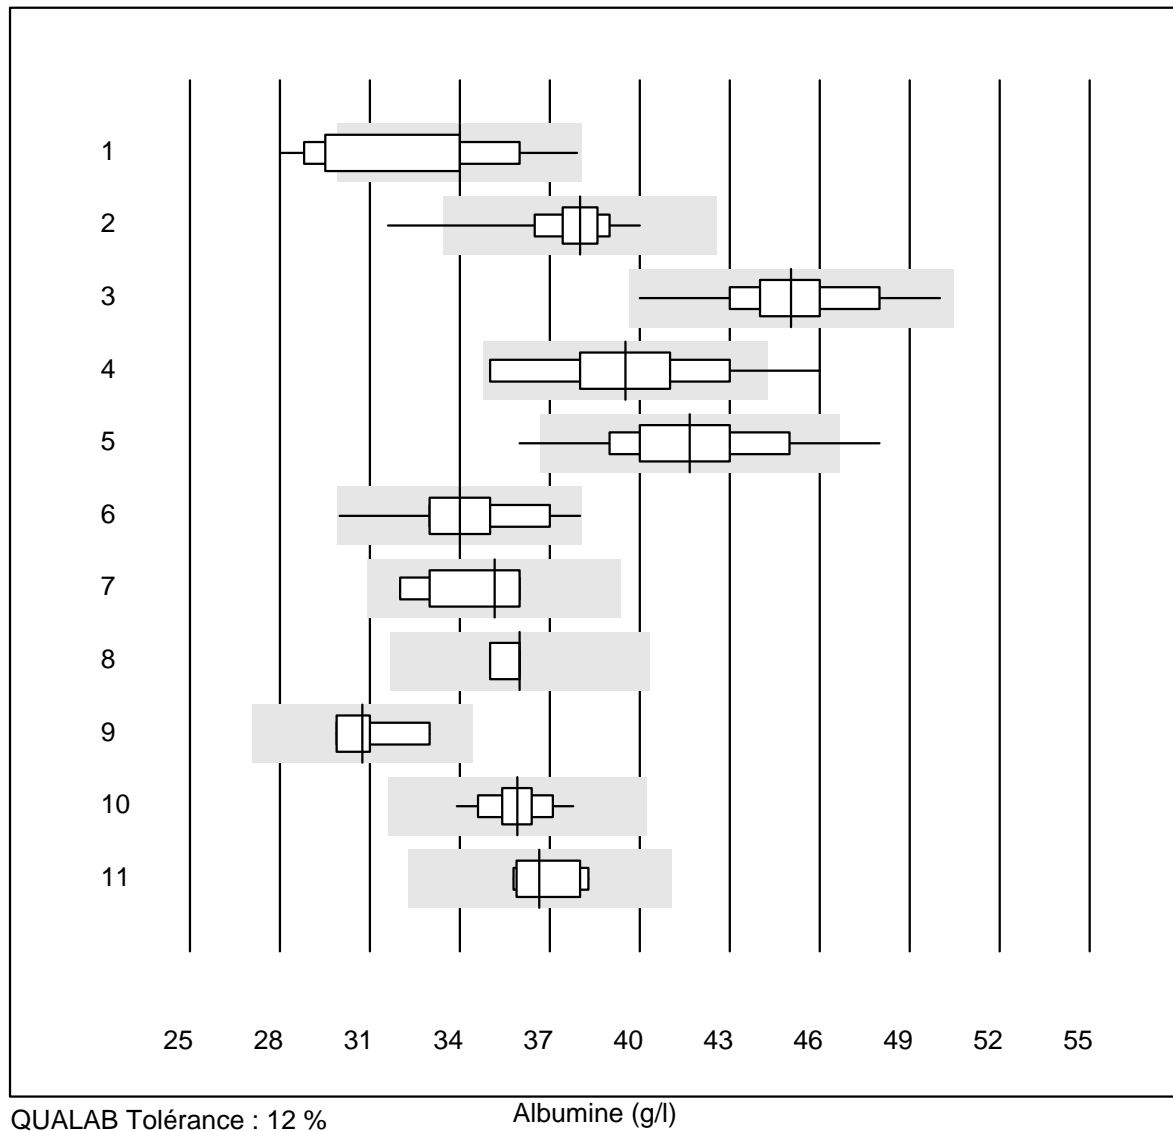

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	16	75.0	25.0	0.0	34	8.3	e*
2 Cobas	22	95.5	4.5	0.0	38	4.7	e
3 Fuji Dri-Chem	244	98.4	0.0	1.6	45	4.1	e
4 Spotchem SP-4430	27	92.6	7.4	0.0	40	7.1	e
5 Spotchem D-Concept	182	94.5	4.4	1.1	42	5.8	e
6 Piccolo	64	98.4	0.0	1.6	34	5.0	e
7 Beckmann	6	100.0	0.0	0.0	35	4.8	e*
8 Skyla	4	100.0	0.0	0.0	36	1.4	e
9 Dimension	4	100.0	0.0	0.0	31	4.3	e*
10 Selectra Pro	11	100.0	0.0	0.0	36	3.0	e
11 Autolyser/DiaSys	8	100.0	0.0	0.0	37	2.9	e

Phosphatase alcaline

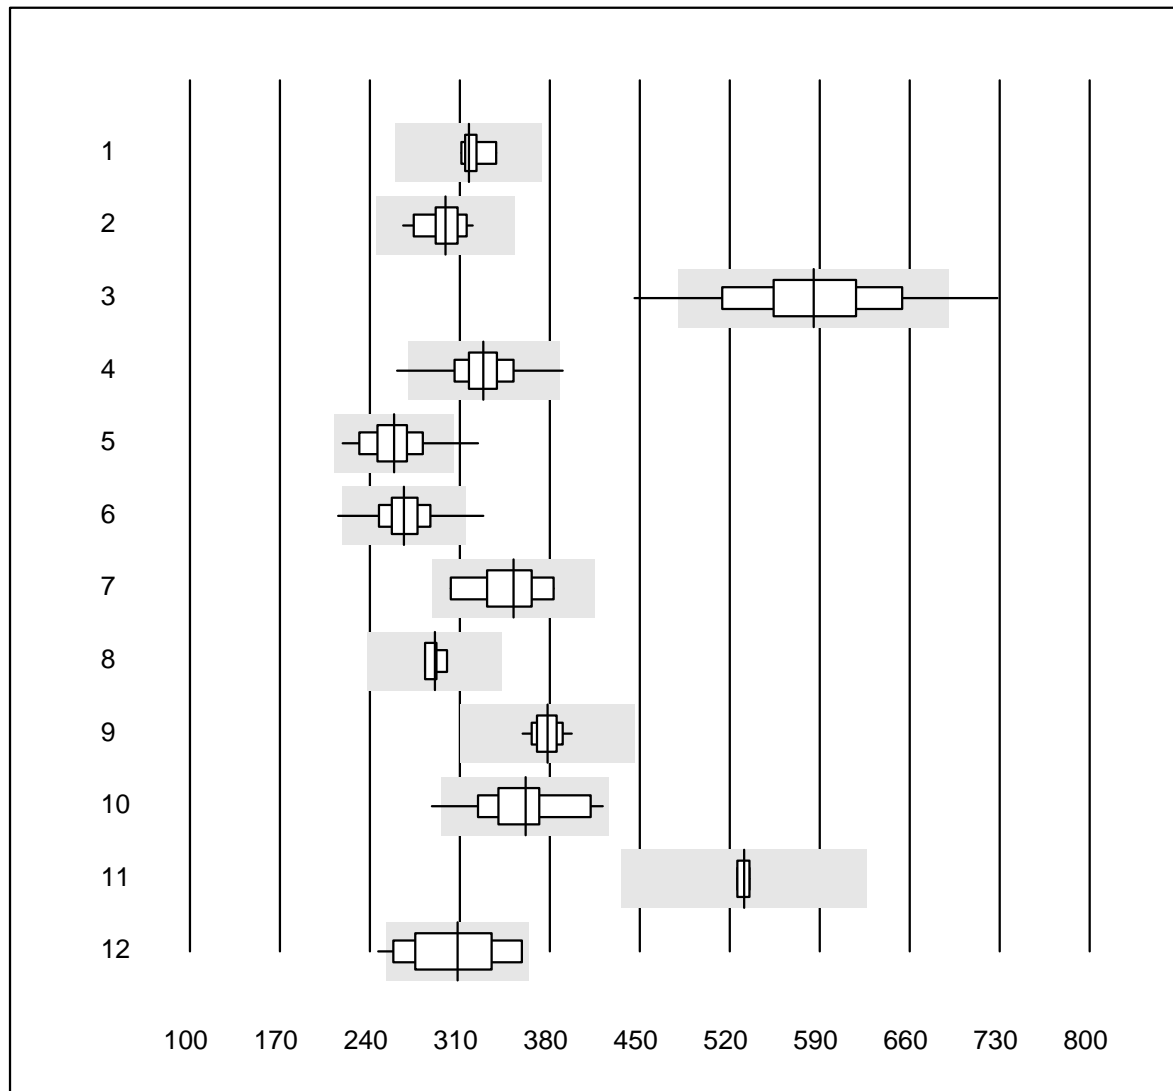


QUALAB Tolérance : 18 %

Phosphatase alcaline (U/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 IFCC	9	100.0	0.0	0.0	317	3.2	e
2 Cobas	23	100.0	0.0	0.0	299	5.0	e
3 Reflotron	303	91.4	4.6	4.0	585	8.9	e
4 Fuji Dri-Chem	927	98.4	0.4	1.2	329	5.5	e
5 Spotchem SP-4430	55	96.4	1.8	1.8	259	7.8	e
6 Spotchem D-Concept	374	98.1	1.1	0.8	267	5.9	e
7 Beckman	8	100.0	0.0	0.0	352	7.5	e*
8 Dimension	4	100.0	0.0	0.0	291	2.4	e
9 Piccolo	55	100.0	0.0	0.0	378	2.5	e
10 Selectra Pro	17	88.2	5.9	5.9	361	9.3	e*
11 Skyla	5	80.0	0.0	20.0	531	0.8	e
12 Autolyser/DiaSys	20	90.0	5.0	5.0	308	11.0	e*
13 Autres méthodes	5	100.0	0.0	0.0	310	5.1	e*

Amylase

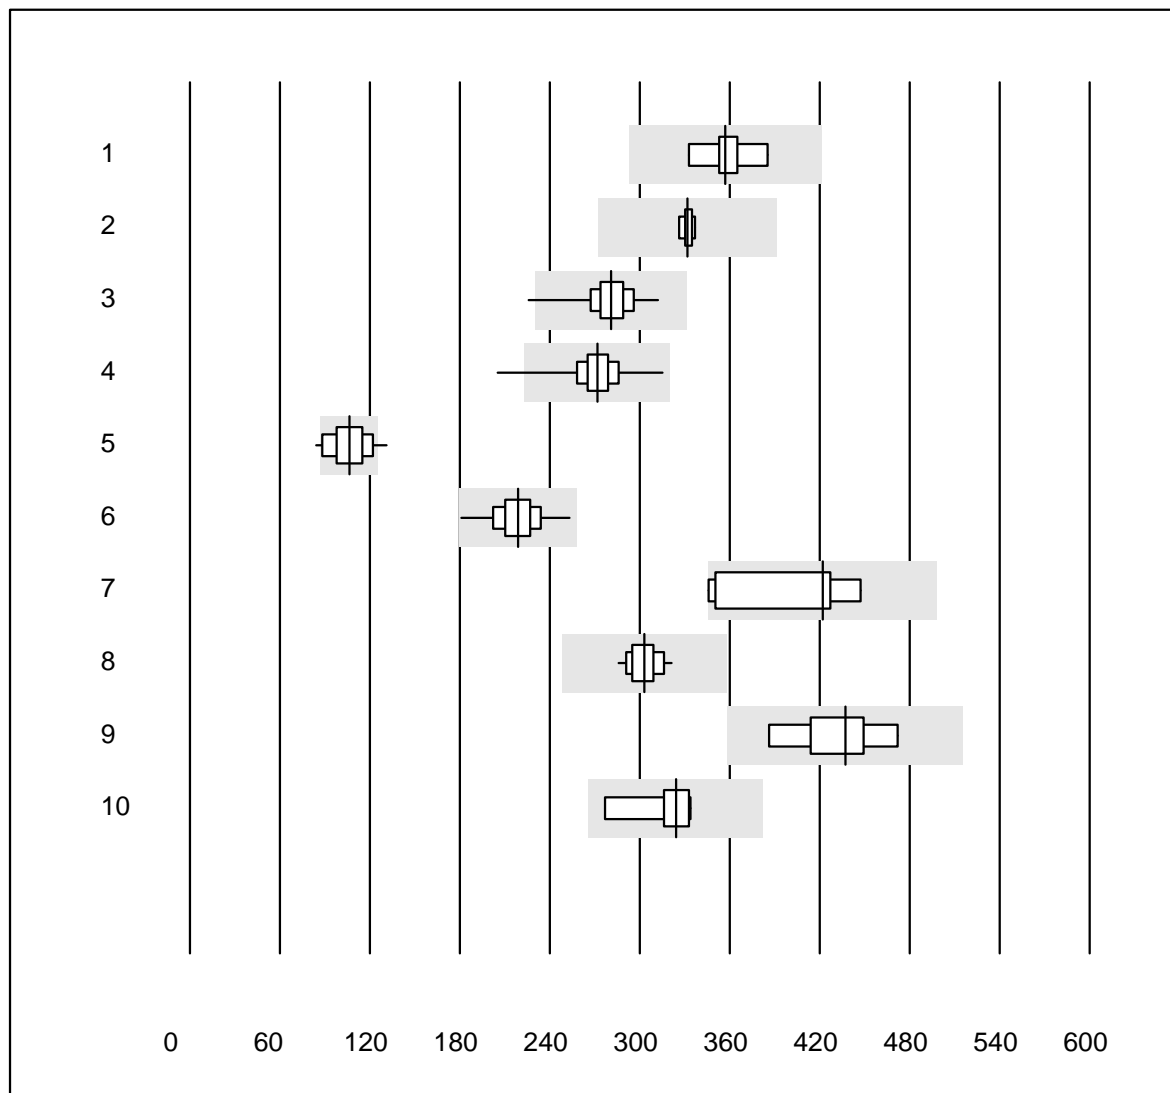


QUALAB Tolérance : 18 %

Amylase (U/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 IFCC	7	100.0	0.0	0.0	357	4.3	e
2 Cobas	8	100.0	0.0	0.0	332	1.1	e
3 Reflotron	83	97.6	2.4	0.0	281	5.2	e
4 Fuji Dri-Chem	673	99.0	0.4	0.6	272	4.2	e
5 Spotchem SP-4430	44	56.8	11.4	31.8	106	11.9	e
6 Spotchem D-Concept	286	99.7	0.0	0.3	219	5.7	e
7 Architect	5	80.0	20.0	0.0	422	11.8	e*
8 Piccolo	58	100.0	0.0	0.0	303	3.0	e
9 Selectra Pro	9	100.0	0.0	0.0	437	6.3	e
10 Autolyser/DiaSys	7	100.0	0.0	0.0	324	6.3	e*

Amylase pancréatique

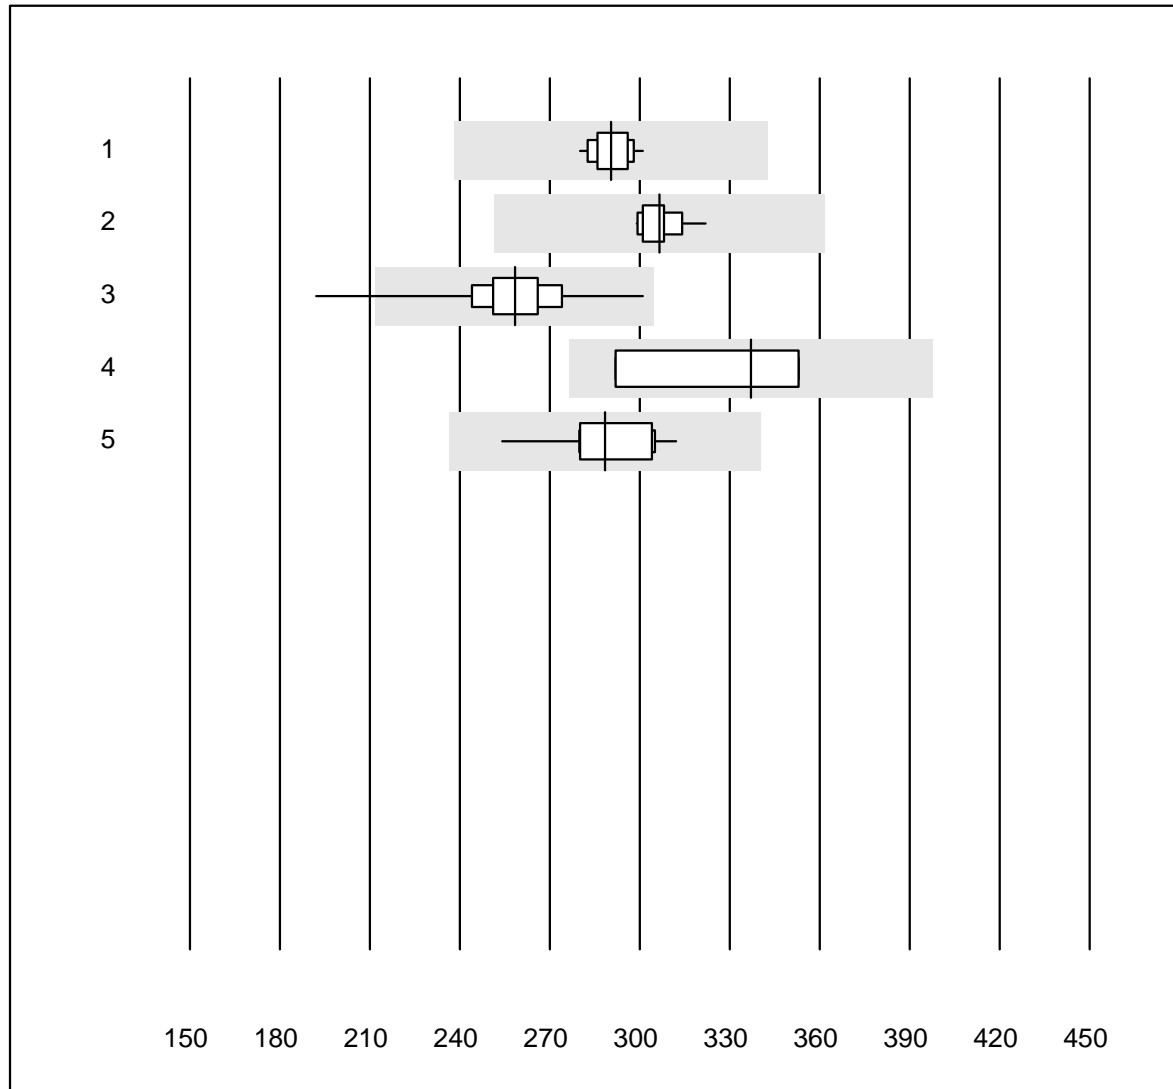


QUALAB Tolérance : 18 %

Amylase pancréatique (U/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 IFCC	11	100.0	0.0	0.0	290	2.2	e
2 Cobas	12	100.0	0.0	0.0	306	2.1	e
3 Reflotron	222	96.4	0.9	2.7	258	5.2	e
4 humide autres 37°C	4	75.0	0.0	25.0	337	9.5	e*
5 Autolyser/DiaSys	11	100.0	0.0	0.0	288	5.4	e

Bilirubine totale

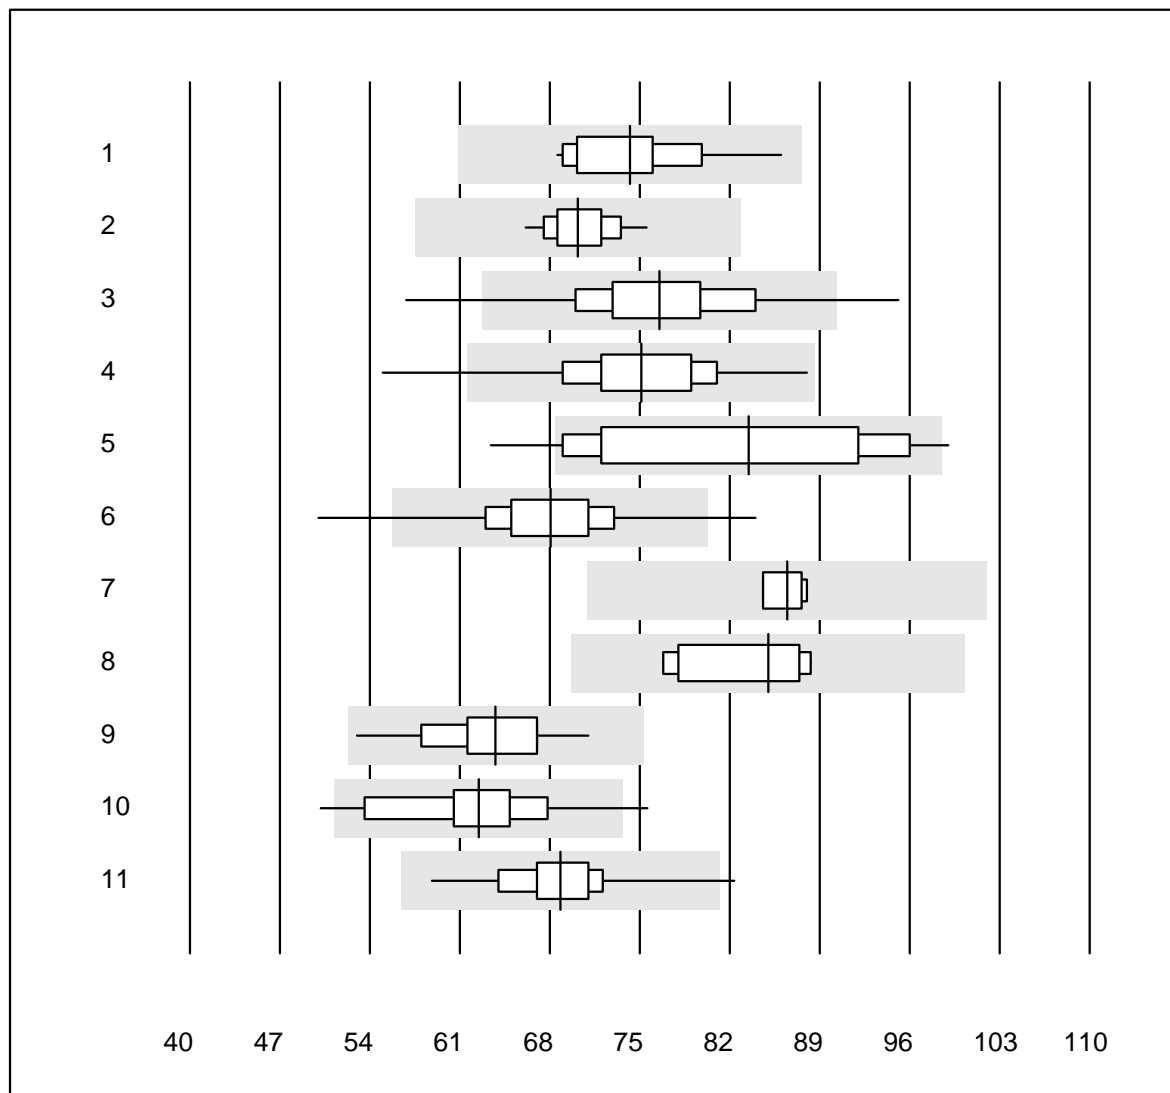


QUALAB Tolérance : 18 %

Bilirubine totale (µmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	Chimie humide	16	100.0	0.0	0.0	74.2	6.2	e
2	Cobas	22	100.0	0.0	0.0	70.2	3.4	e
3	Reflotron	239	92.5	3.3	4.2	76.6	7.9	e
4	Fuji Dri-Chem	754	96.8	1.9	1.3	75.1	6.5	e
5	Spotchem SP-4430	55	83.6	9.1	7.3	83.5	12.6	e
6	Spotchem D-Concept	296	96.2	2.4	1.4	68.0	7.0	e
7	Dimension	4	100.0	0.0	0.0	86.5	1.9	e
8	Beckman	7	100.0	0.0	0.0	85.0	5.7	e
9	Piccolo	66	95.5	0.0	4.5	63.8	6.3	e
10	Selectra Pro	18	77.8	11.1	11.1	62.5	9.2	e*
11	Autolyser/DiaSys	17	94.1	5.9	0.0	68.8	7.1	e

Bilirubine directe

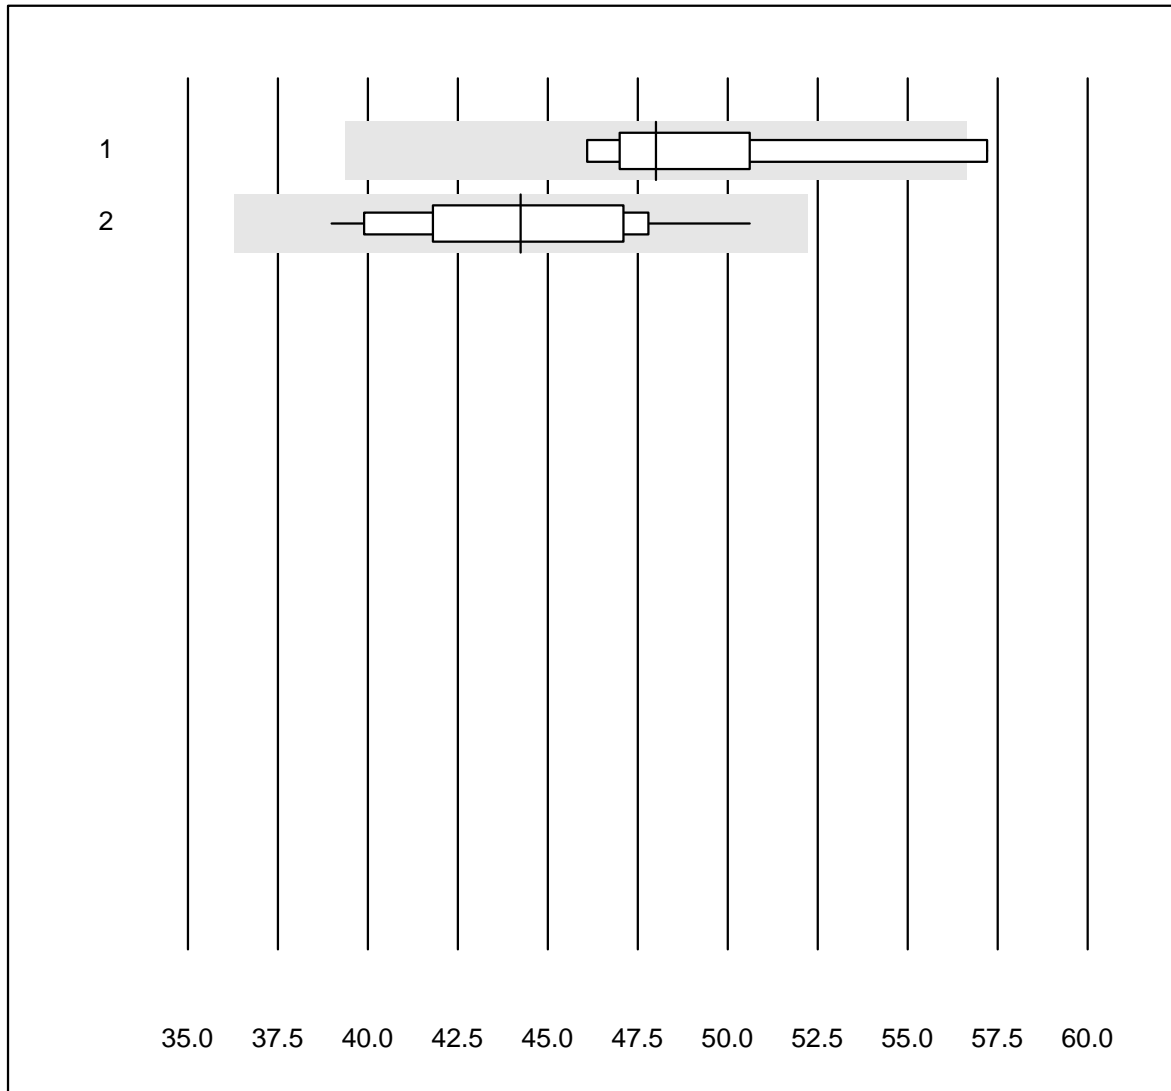


Tolérance MQ : 18 %

Bilirubine directe (µmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Autolyser/DiaSys	9	88.9	11.1	0.0	48.0	7.0	e*
2 Fuji Dri-Chem	29	89.7	0.0	10.3	44.3	7.1	e

Calcium

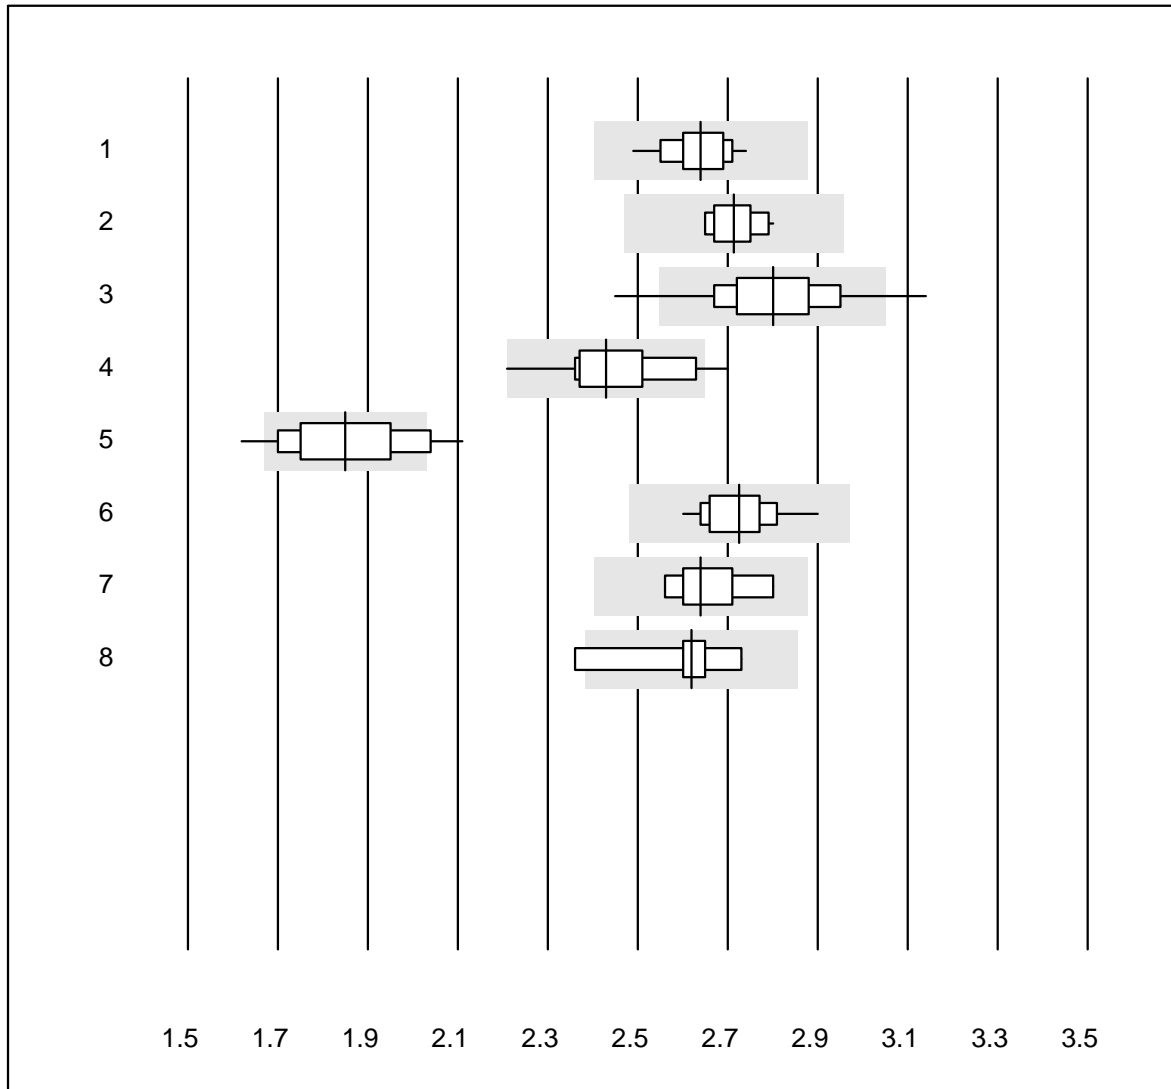


QUALAB Tolérance : 9 %
(< 2.00: +/- 0.18 mmol/l)

Calcium (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	Chimie humide	26	100.0	0.0	0.0	2.64	2.4	e
2	Cobas	22	100.0	0.0	0.0	2.71	1.8	e
3	Fuji Dri-Chem	346	96.3	2.3	1.4	2.80	3.9	e
4	Spotchem SP-4430	14	71.4	14.3	14.3	2.43	5.2	e*
5	Spotchem D-Concept	78	76.9	15.4	7.7	1.85	6.8	e
6	Piccolo	56	100.0	0.0	0.0	2.72	2.5	e
7	Selectra Pro	7	100.0	0.0	0.0	2.64	3.0	e*
8	Autolyser/DiaSys	9	88.9	11.1	0.0	2.62	4.3	e*

Calcium ISE

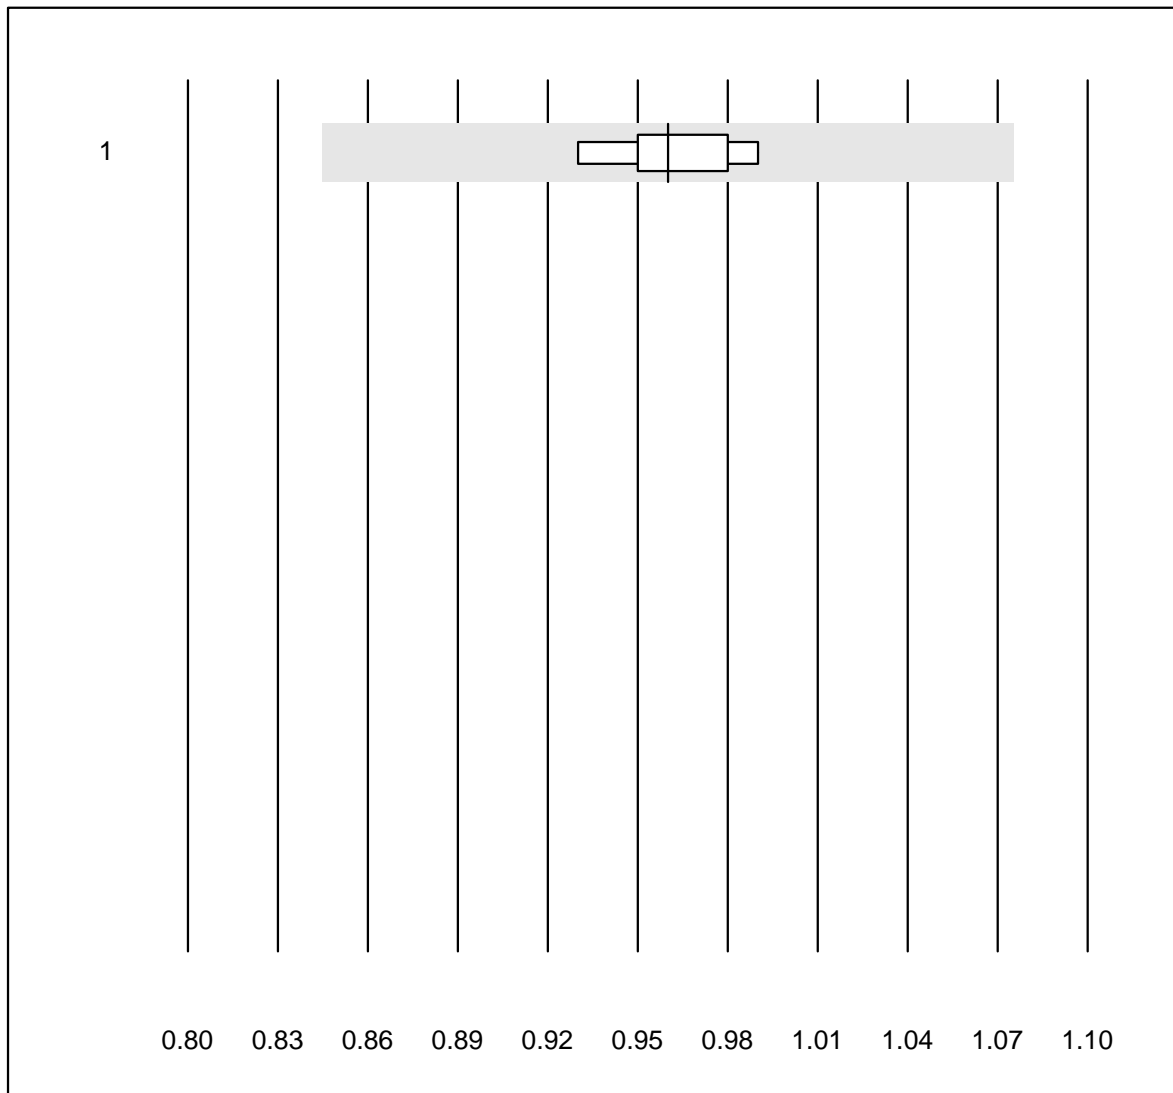


Tolérance MQ : 12 %

Calcium ISE (mmol/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 iStat Chem8	5	100.0	0.0	0.0	0.96	2.5	e

Chlorures

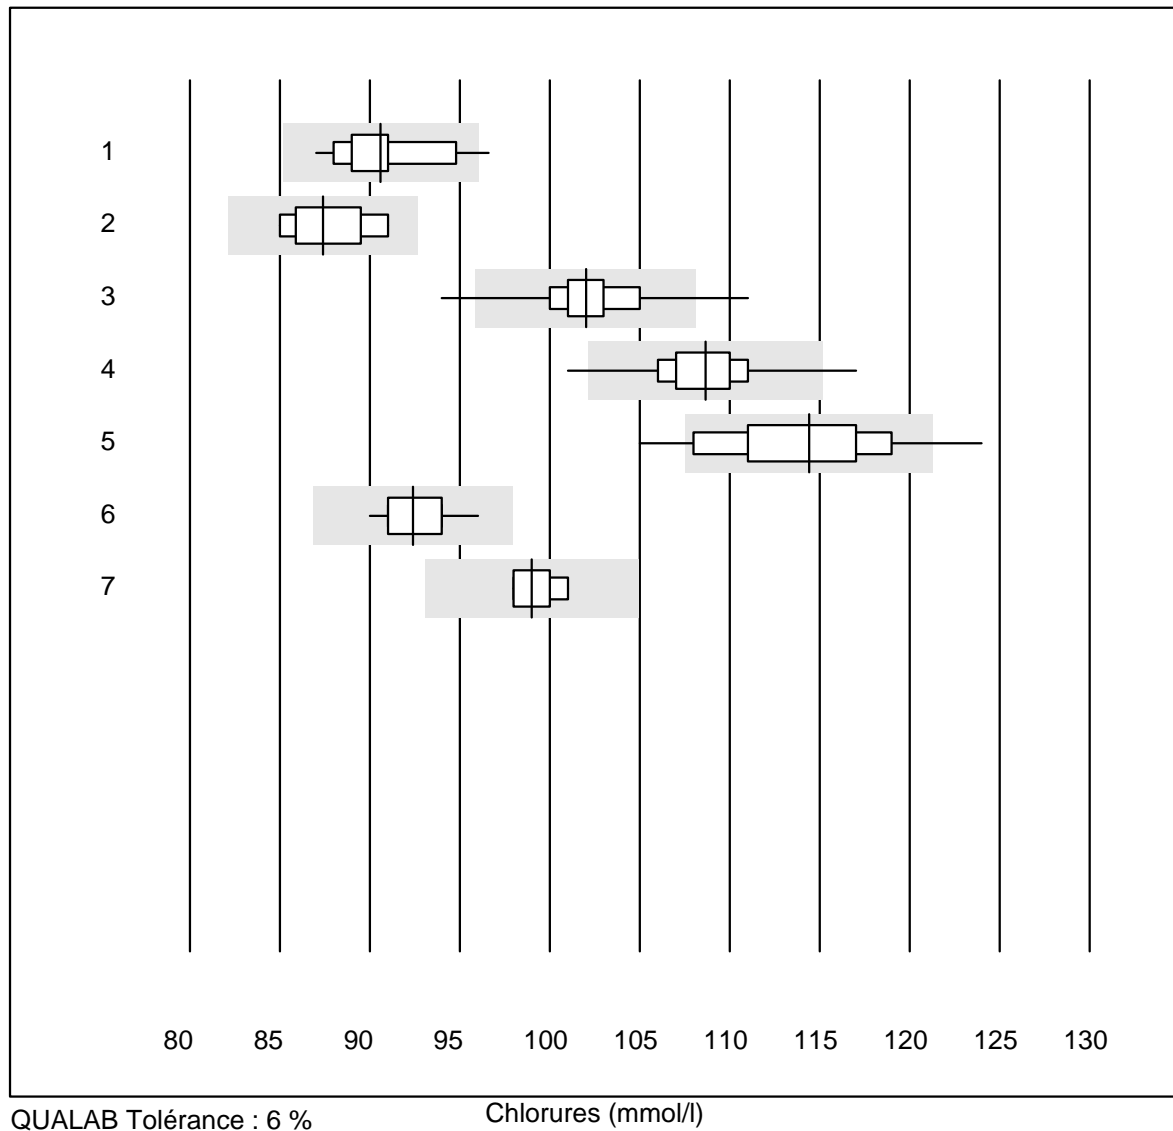

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 ISE	27	92.6	7.4	0.0	91	2.9	e
2 Cobas	14	92.9	0.0	7.1	87	2.6	e
3 Fuji Dri-Chem	839	97.7	1.5	0.8	102	2.1	e
4 Spotchem D-Concept	337	96.1	2.7	1.2	109	2.1	e
5 Spotchem EL-SE 1520	60	80.0	13.3	6.7	114	3.8	e
6 Piccolo	26	100.0	0.0	0.0	92	1.6	e
7 iStat Chem8	5	100.0	0.0	0.0	99	1.3	e

Cholestérol

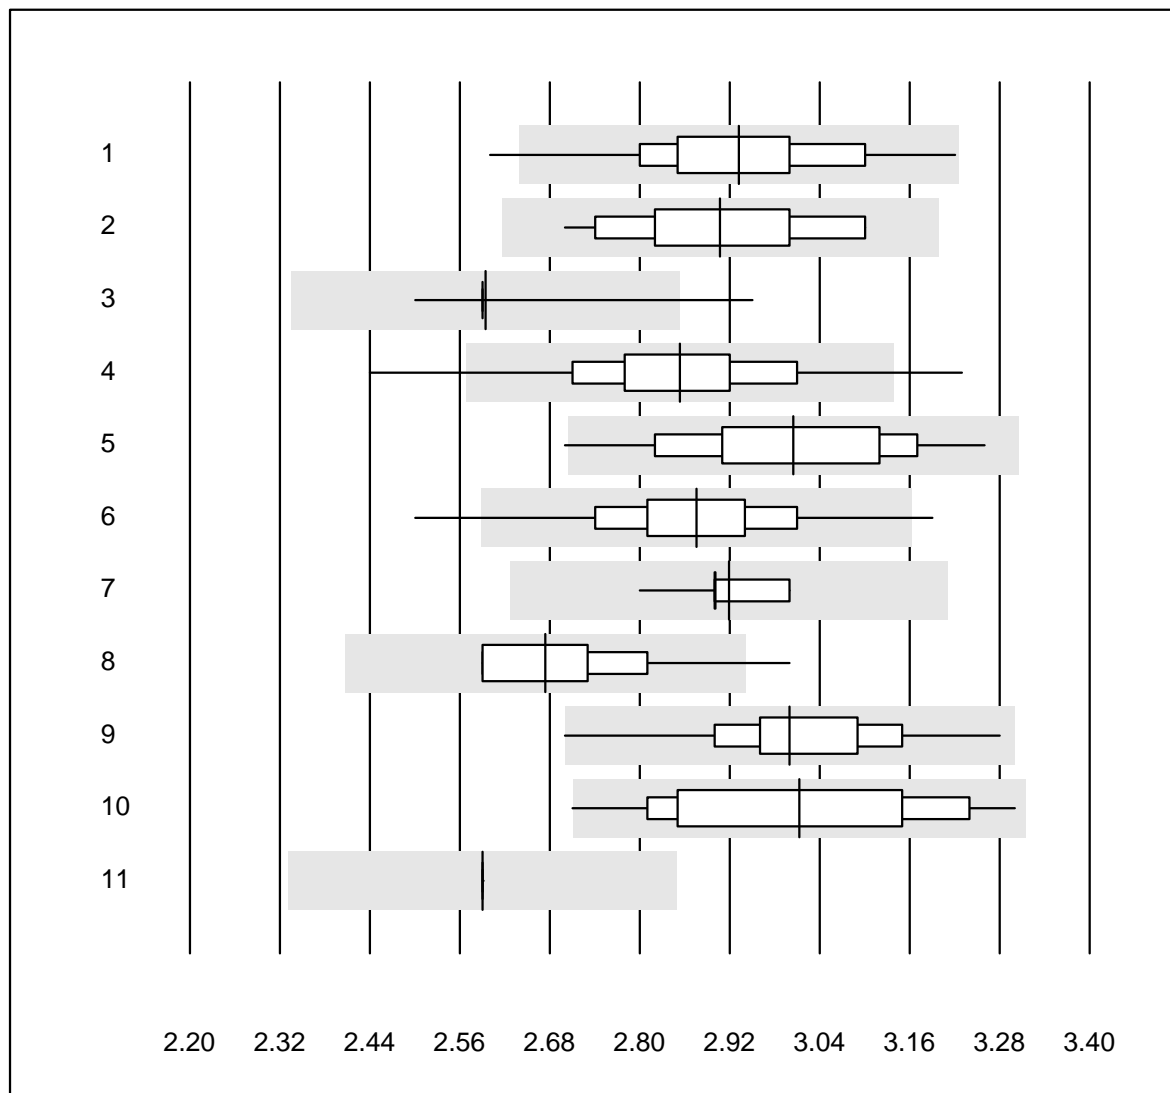


QUALAB Tolérance : 10 %

Cholestérol (mmol/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	25	96.0	4.0	0.0	2.93	4.6	e
2 Cobas	22	100.0	0.0	0.0	2.91	4.0	e
3 Reflotron	190	97.3	1.1	1.6	2.59	1.6	e
4 Fuji Dri-Chem	893	96.8	1.9	1.3	2.85	4.0	e
5 Spotchem SP-4430	74	98.6	1.4	0.0	3.00	4.4	e
6 Spotchem D-Concept	375	97.1	1.3	1.6	2.88	3.7	e
7 Piccolo	31	100.0	0.0	0.0	2.92	1.6	e
8 Cholestech LDX	302	98.0	1.0	1.0	2.67	3.5	e
9 Selectra Pro	15	86.6	6.7	6.7	3.00	4.5	e
10 Autolyser/DiaSys	20	90.0	5.0	5.0	3.01	5.3	e
11 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	2.59	0.0	e

Cholestérol HDL

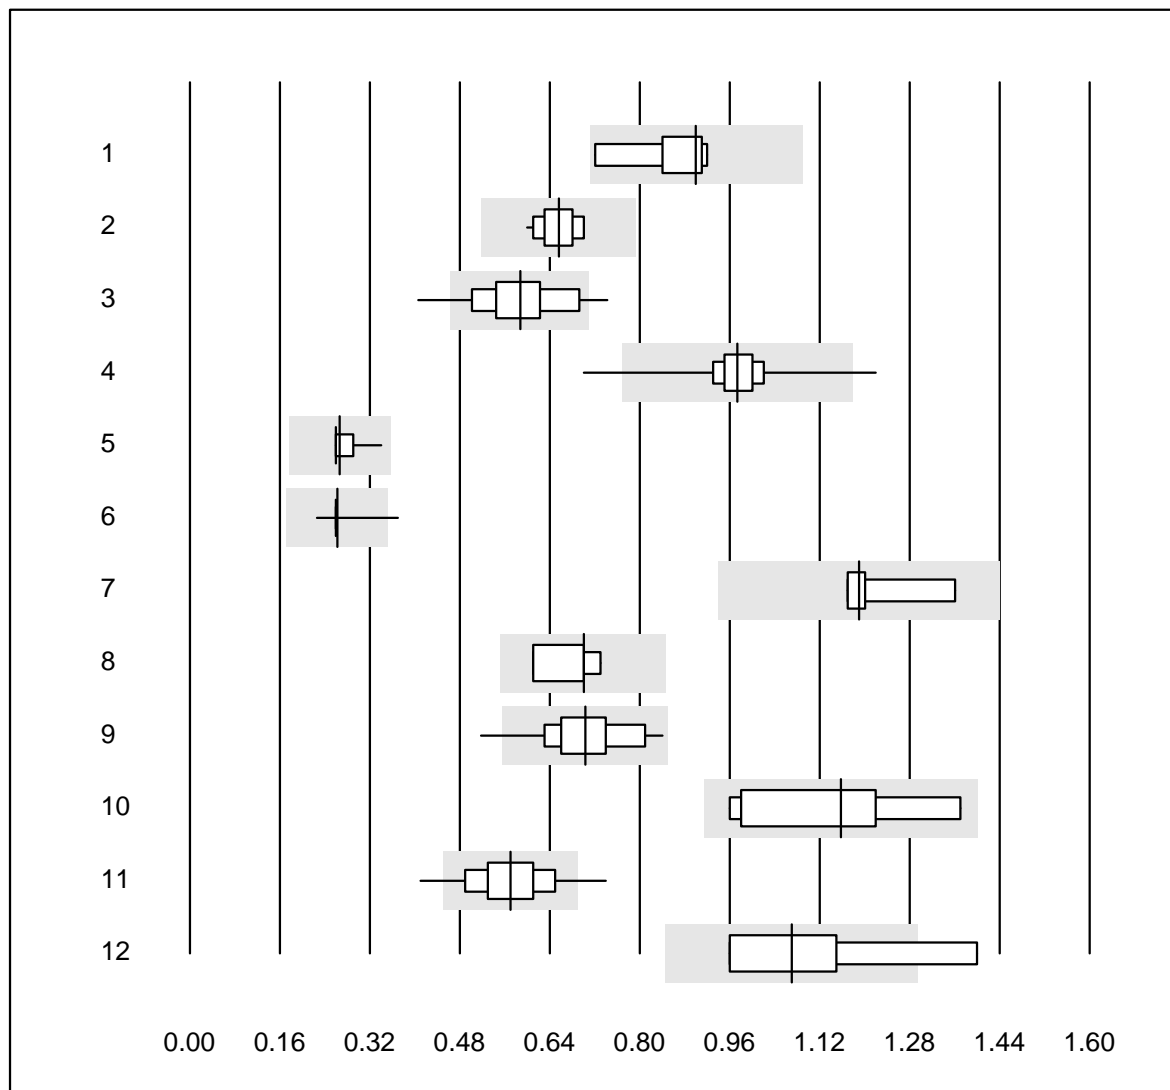


QUALAB Tolérance : 21 %
(< 0.40: +/- 0.09 mmol/l)

Cholestérol HDL (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	humide, direct	7	100.0	0.0	0.0	0.90	8.1	e*
2	Cobas	19	100.0	0.0	0.0	0.66	4.9	e
3	Reflotron	118	83.1	5.9	11.0	0.59	11.7	e
4	Fuji Dri-Chem	863	99.1	0.3	0.6	0.97	3.9	e
5	Spotchem SP-4430	65	98.5	0.0	1.5	0.27	5.8	e
6	Spotchem D-Concept	357	98.6	0.3	1.1	0.26	3.6	e
7	Dimension	4	100.0	0.0	0.0	1.19	7.3	e*
8	humide, precipitatio	4	100.0	0.0	0.0	0.70	7.6	e*
9	Piccolo	29	89.7	6.9	3.4	0.70	11.0	e
10	Pentra/Selectra	12	66.7	0.0	33.3	1.16	12.0	e*
11	Cholestech LDX	302	85.4	7.0	7.6	0.57	11.2	e
12	Selectra Pro	4	75.0	25.0	0.0	1.07	17.9	e*
13	Architect	9	100.0	0.0	0.0	0.70	4.2	e
14	Autolysér/DiaSys	20	90.0	5.0	5.0	1.11	10.5	e

Créatine-kinase

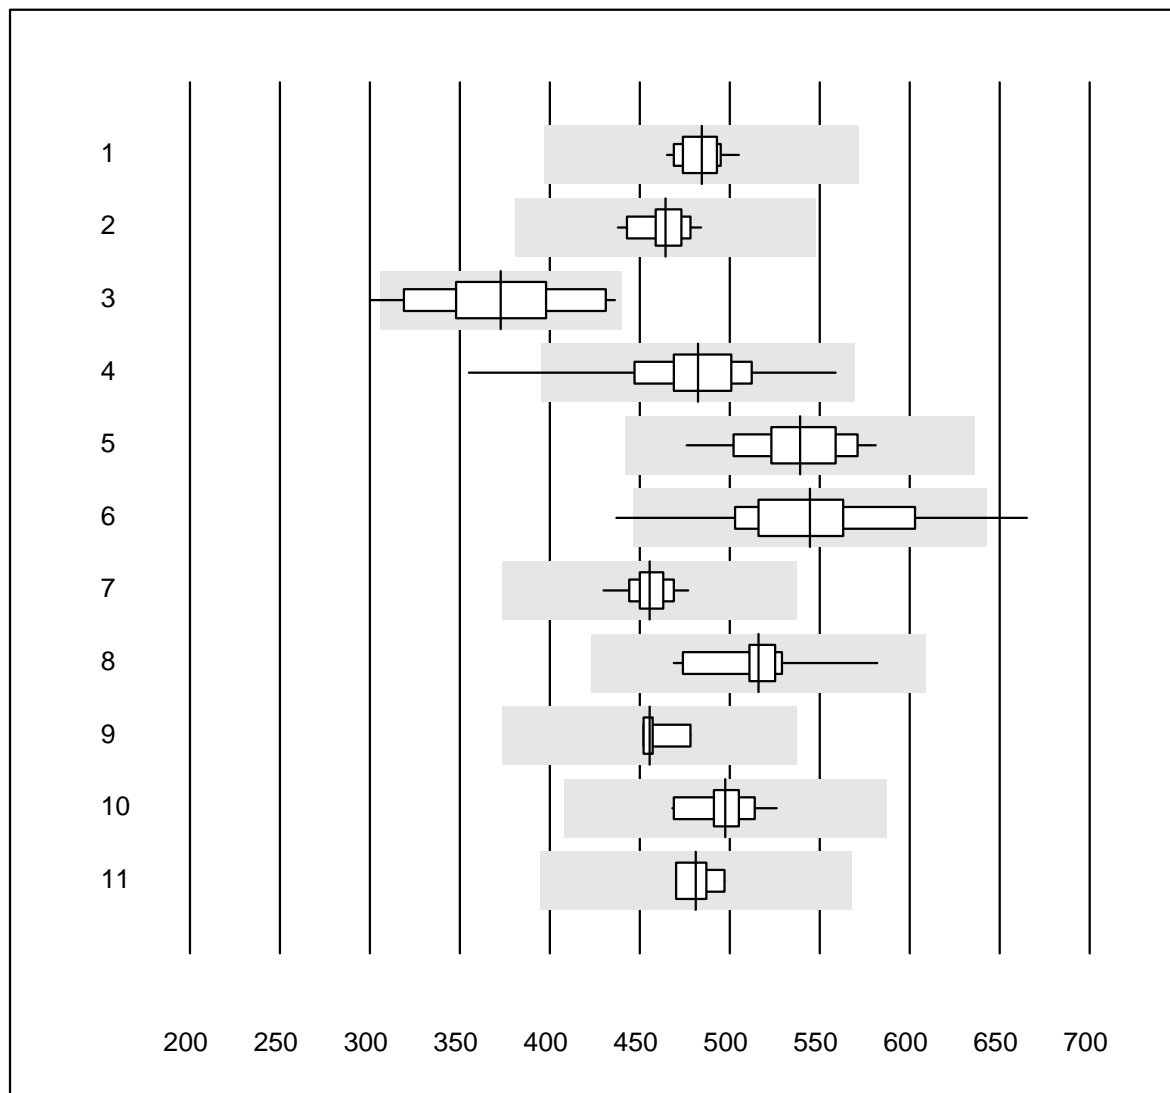


QUALAB Tolérance : 18 %

Créatine-kinase (U/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 IFCC	19	100.0	0.0	0.0	484	2.2	e
2 Cobas	20	100.0	0.0	0.0	464	2.5	e
3 Reflotron	18	77.7	5.6	16.7	373	10.6	e*
4 Fuji Dri-Chem	613	98.1	0.8	1.1	482	5.7	e
5 Spotchem SP-4430	32	100.0	0.0	0.0	539	5.1	e
6 Spotchem D-Concept	226	95.6	3.1	1.3	545	7.5	e
7 Piccolo	26	100.0	0.0	0.0	455	2.5	e
8 Selectra Pro	14	92.9	0.0	7.1	516	5.4	e
9 Dimension	4	100.0	0.0	0.0	456	2.6	e
10 Autolyser/DiaSys	16	100.0	0.0	0.0	497	3.0	e
11 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	481	2.5	e

Cholestérol LDL

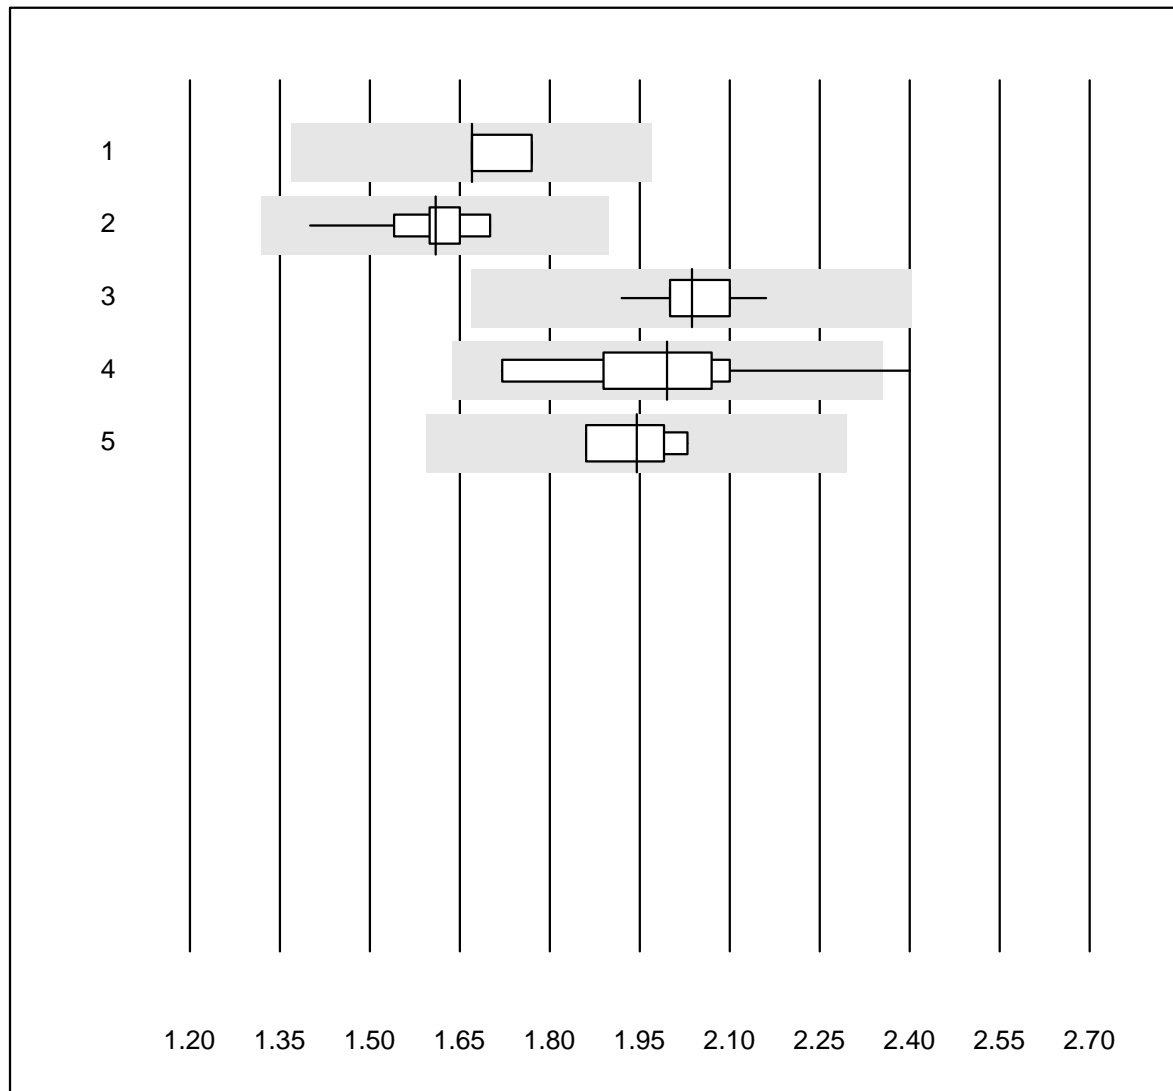


QUALAB Tolérance : 18 %

Cholestérol LDL (mmol/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Selectra	5	60.0	0.0	40.0	1.7	3.1	e
2 Chimie humide	15	100.0	0.0	0.0	1.6	4.5	e
3 Roche, Cobas	11	100.0	0.0	0.0	2.0	3.2	e
4 Autolyser/DiaSys	13	69.2	7.7	23.1	2.0	9.2	e*
5 Beckman	4	100.0	0.0	0.0	1.9	4.0	e

Fer

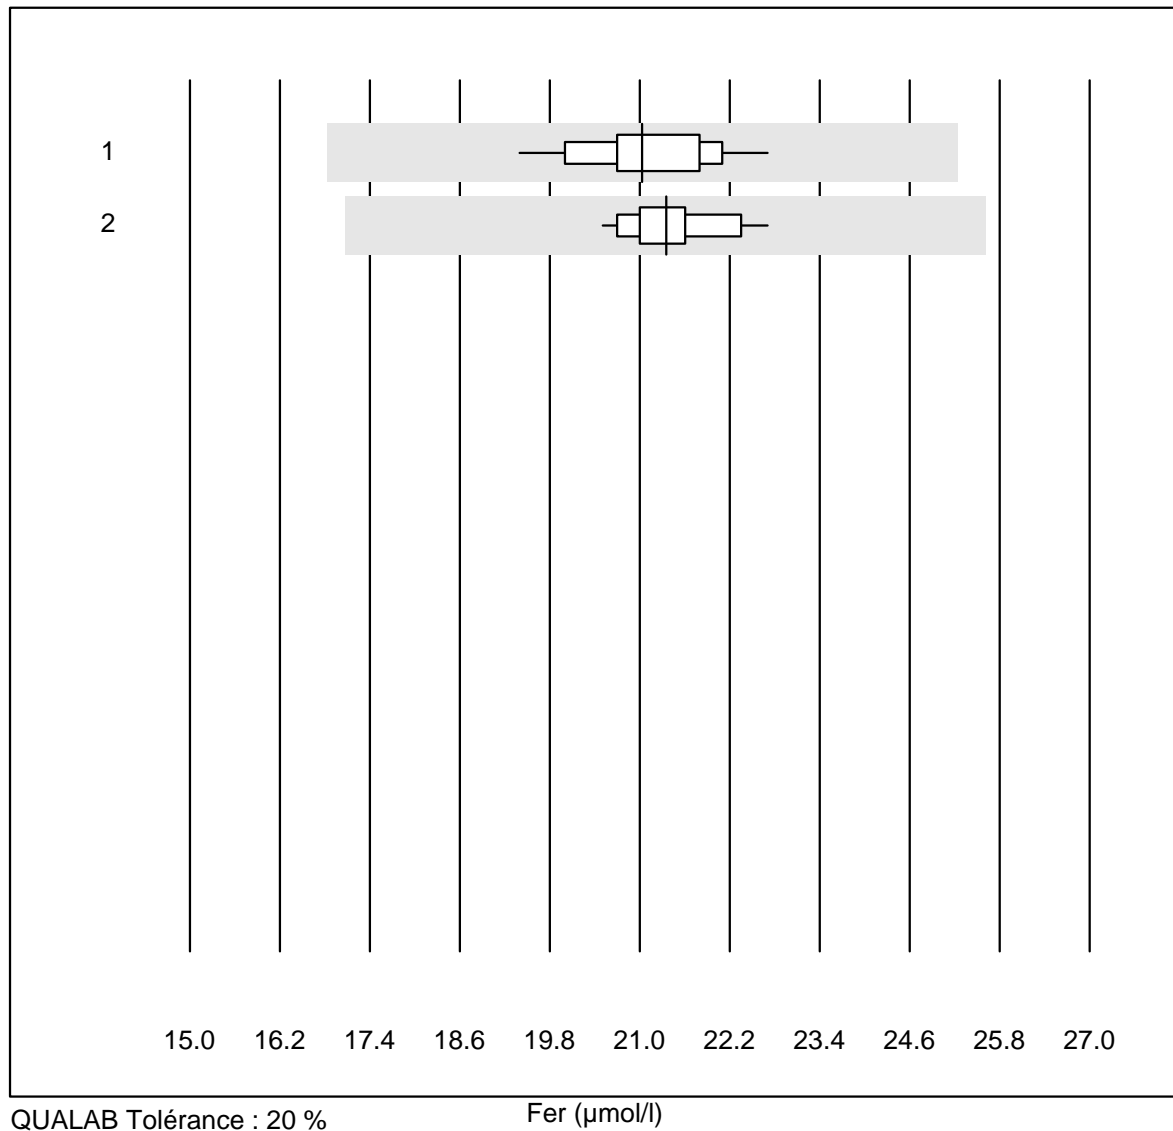

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	15	100.0	0.0	0.0	21	4.0	e
2 Cobas	13	100.0	0.0	0.0	21	3.1	e

Gamma-GT

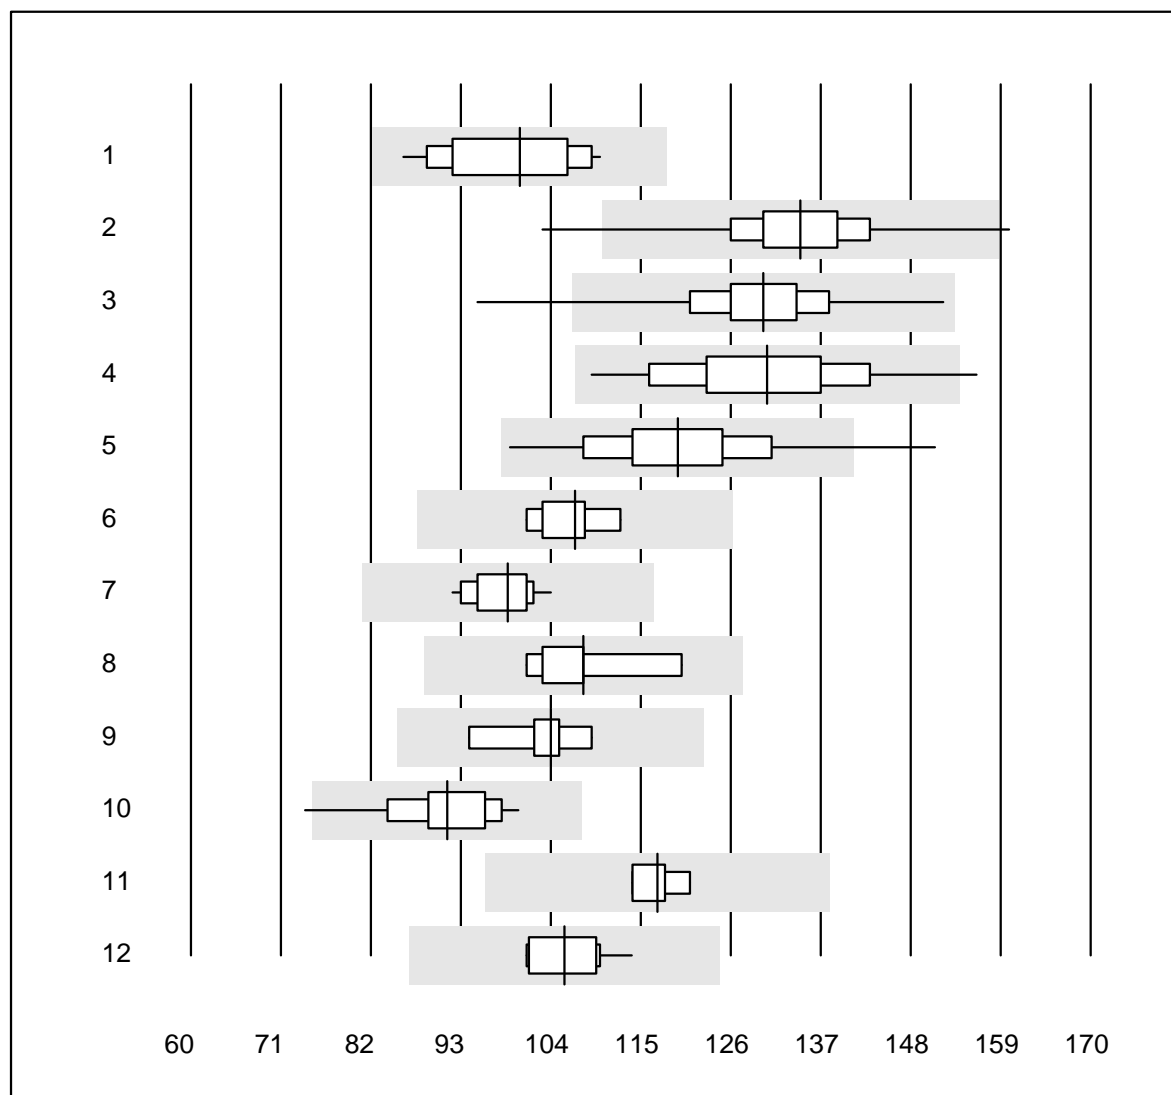


QUALAB Tolérance : 18 %

Gamma-GT (U/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	23	100.0	0.0	0.0	100	7.9	e
2 Reflotron	427	95.8	0.7	3.5	134	5.4	e
3 Fuji Dri-Chem	1014	99.0	0.2	0.8	130	5.2	e
4 Spotchem SP-4430	85	98.8	1.2	0.0	130	7.7	e
5 Spotchem D-Concept	422	97.7	1.4	0.9	120	7.3	e
6 Selectra/Biolis	5	100.0	0.0	0.0	107	4.2	e
7 Architect	12	100.0	0.0	0.0	99	3.7	e
8 Dimension	5	100.0	0.0	0.0	108	6.8	e*
9 IFCC Beckmann	6	100.0	0.0	0.0	104	4.9	e
10 Piccolo	55	98.2	1.8	0.0	91	6.3	e
11 Skyla	4	100.0	0.0	0.0	117	2.5	e
12 Selectra Pro	12	91.7	0.0	8.3	106	4.3	e
13 Autolyser/DiaSys	20	100.0	0.0	0.0	108	5.0	e

Glucose

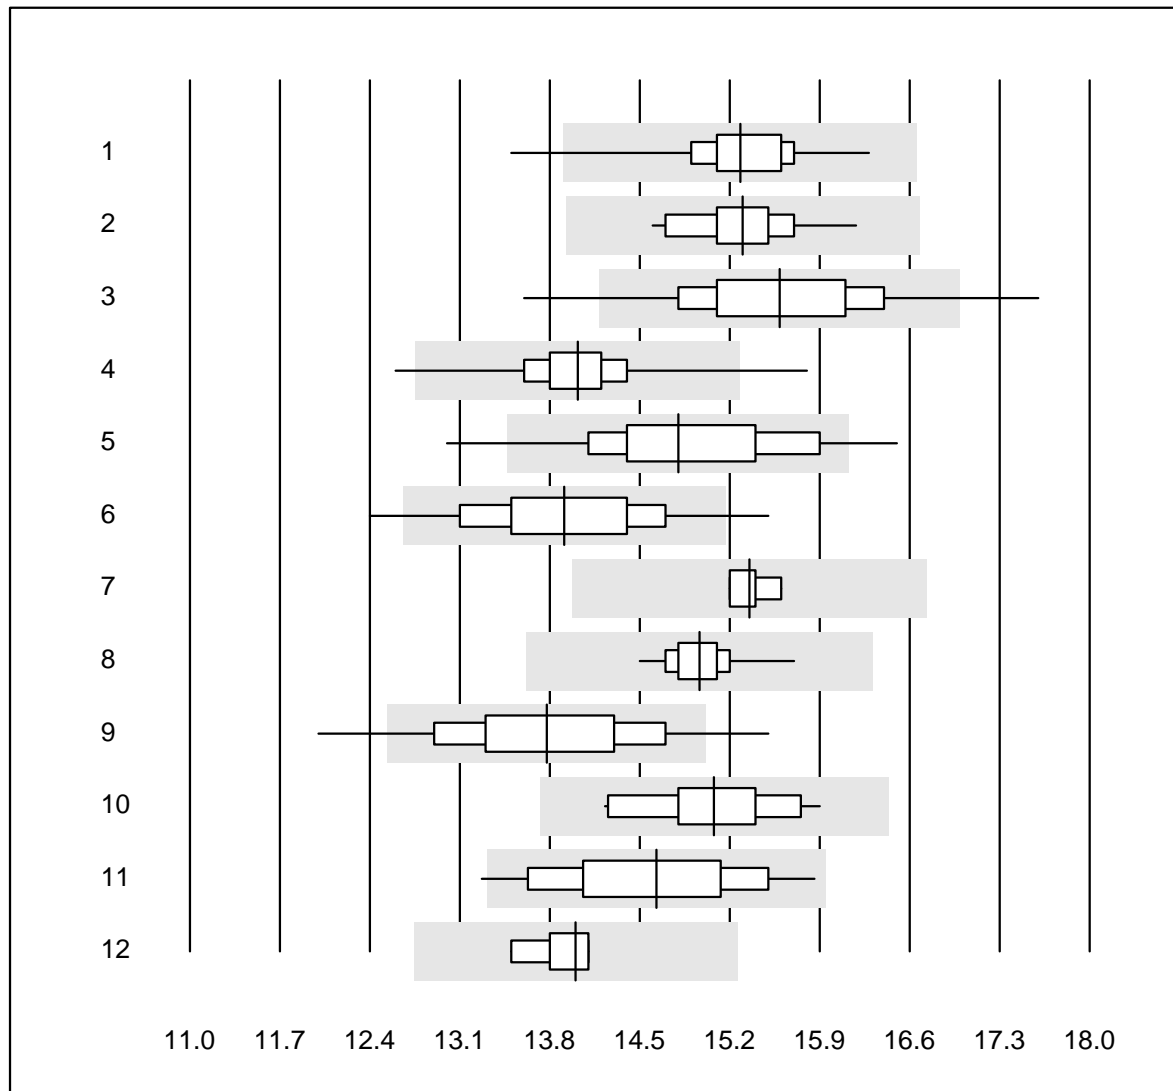


QUALAB Tolérance : 9 %

Glucose (mmol/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	26	96.2	3.8	0.0	15.3	3.5	e
2 Cobas	22	100.0	0.0	0.0	15.3	2.7	e
3 Reflotron	412	91.8	5.3	2.9	15.6	4.5	e
4 Fuji Dri-Chem	956	98.7	0.5	0.8	14.0	2.3	e
5 Spotchem SP-4430	74	90.5	5.4	4.1	14.8	4.8	e
6 Spotchem D-Concept	396	94.4	5.1	0.5	13.9	4.4	e
7 Dimension	4	100.0	0.0	0.0	15.4	1.1	e
8 Piccolo	72	100.0	0.0	0.0	15.0	1.5	e
9 Cholestech LDX	298	86.3	7.7	6.0	13.8	5.1	e
10 Selectra Pro	18	94.4	0.0	5.6	15.1	3.2	e
11 Autolyser/DiaSys	20	95.0	5.0	0.0	14.6	4.9	e*
12 iStat Chem8	7	100.0	0.0	0.0	14.0	1.5	e

Glucose

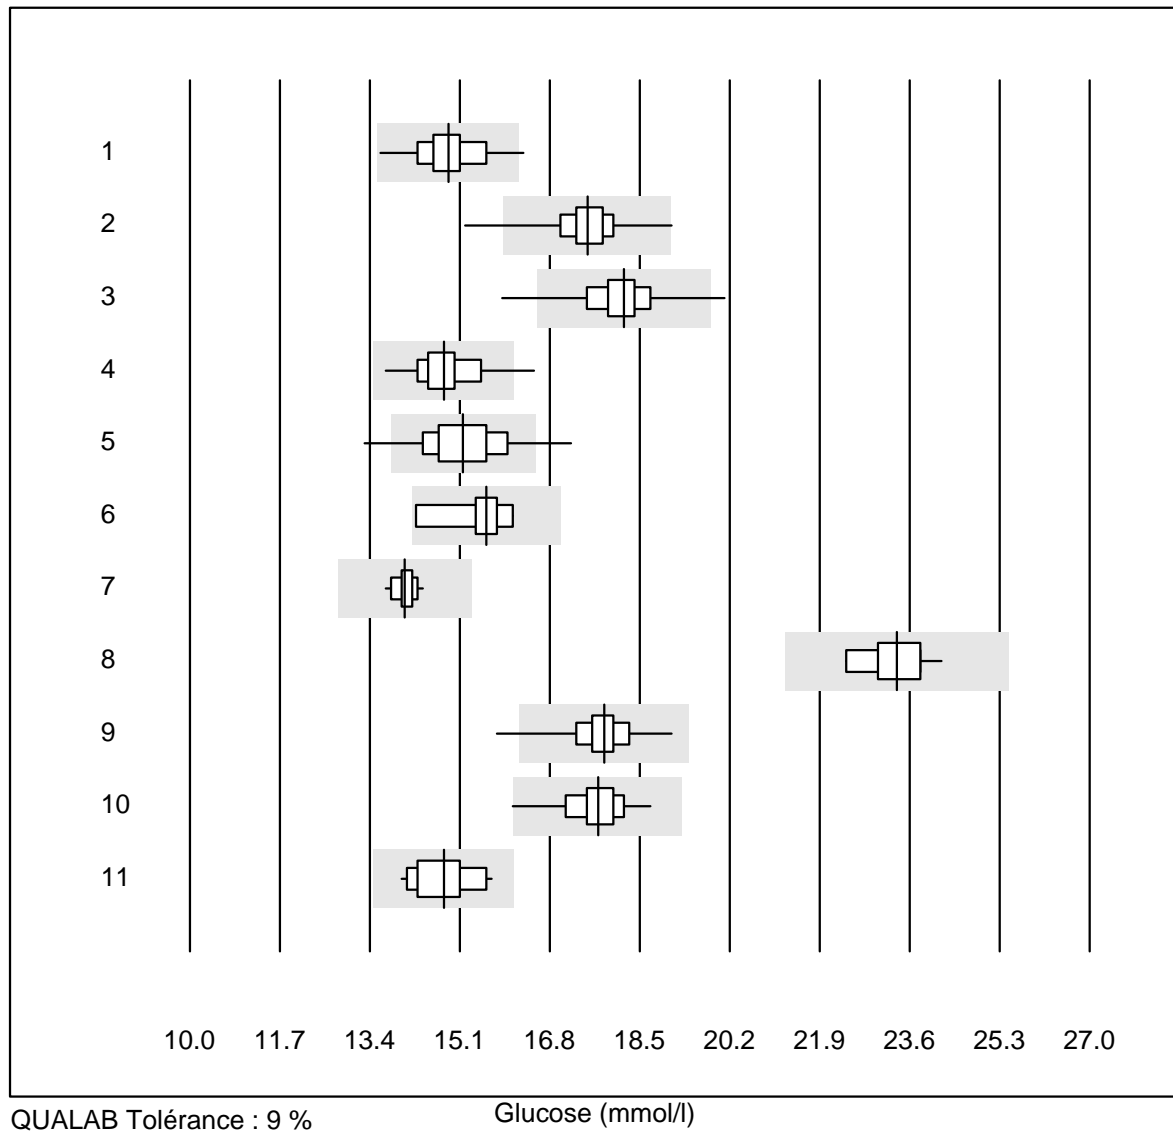


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Accu-Chek Instant	93	98.9	1.1	0.0	14.9	3.4	e
2 Accu-Chek Aviva	251	92.4	2.4	5.2	17.5	2.9	e
3 Accu-Chek Inform 2	782	98.5	1.5	0.0	18.2	2.9	e
4 Accu-Check Guide	279	97.8	1.1	1.1	14.8	3.2	e
5 Contour XT	1326	95.8	3.2	1.0	15.2	4.1	e
6 Skyla	6	100.0	0.0	0.0	15.6	4.1	e*
7 Statstrip/Xpress	100	100.0	0.0	0.0	14.1	1.1	e
8 Glucocard	11	90.9	0.0	9.1	23.4	2.4	e
9 Hemocue 201+ P-equiv	104	97.1	1.0	1.9	17.8	2.4	e
10 Hemocue 201RT P-equi	124	99.2	0.8	0.0	17.7	2.5	e
11 Contour NEXT	11	100.0	0.0	0.0	14.8	3.7	e*

Glucose

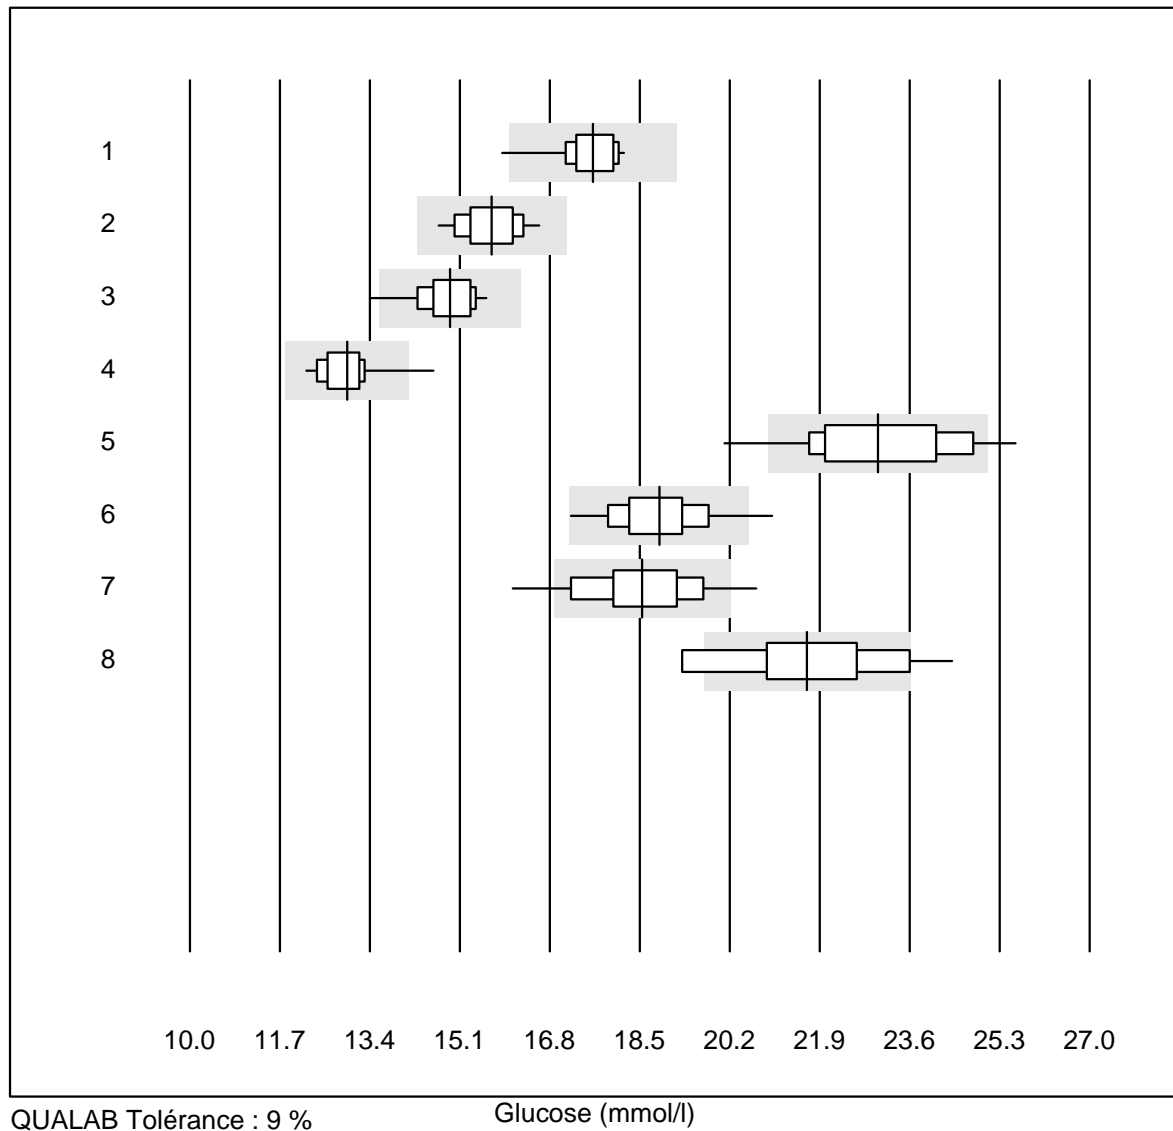

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Hemocue 201+ (alt)	34	97.1	2.9	0.0	17.6	2.9	e
2 AccuChek Sensor	32	93.7	0.0	6.3	15.7	2.9	e
3 OneTouch Verio	25	96.0	4.0	0.0	14.9	3.6	e
4 Contour 2 (5s)	14	85.8	7.1	7.1	13.0	4.6	e*
5 Healthpro	28	71.4	10.7	17.9	23.0	5.8	e*
6 Mylife UNIO	379	97.9	1.6	0.5	18.9	3.8	e
7 mylife Pura	96	84.4	8.3	7.3	18.5	5.3	e
8 Alpha Check	22	40.9	18.2	40.9	21.7	7.3	e*

Acide urique

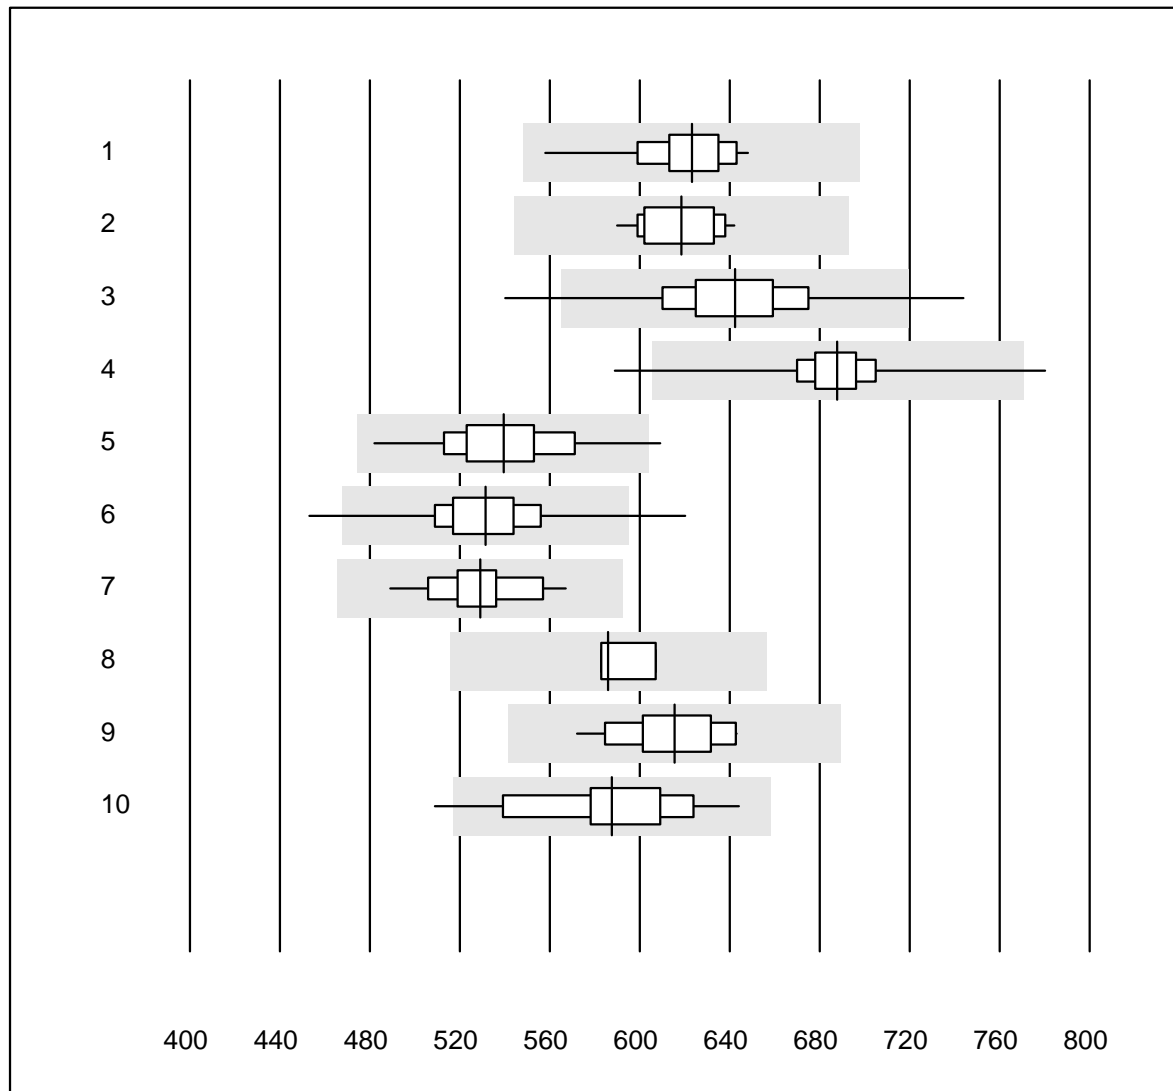


QUALAB Tolérance : 12 %

Acide urique (µmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	30	100.0	0.0	0.0	623	3.2	e
2 Cobas	20	100.0	0.0	0.0	618	2.7	e
3 Reflotron	348	96.0	1.7	2.3	642	4.3	e
4 Fuji Dri-Chem	943	98.3	0.4	1.3	688	2.4	e
5 Spotchem SP-4430	68	98.5	1.5	0.0	539	4.5	e
6 Spotchem D-Concept	393	98.7	0.8	0.5	531	3.8	e
7 Piccolo	35	100.0	0.0	0.0	529	3.5	e
8 Skyla	5	80.0	0.0	20.0	586	2.2	e
9 Selectra Pro	16	93.7	0.0	6.3	616	3.4	e
10 Autolyser/DiaSys	19	94.7	5.3	0.0	587	5.4	e

Urée

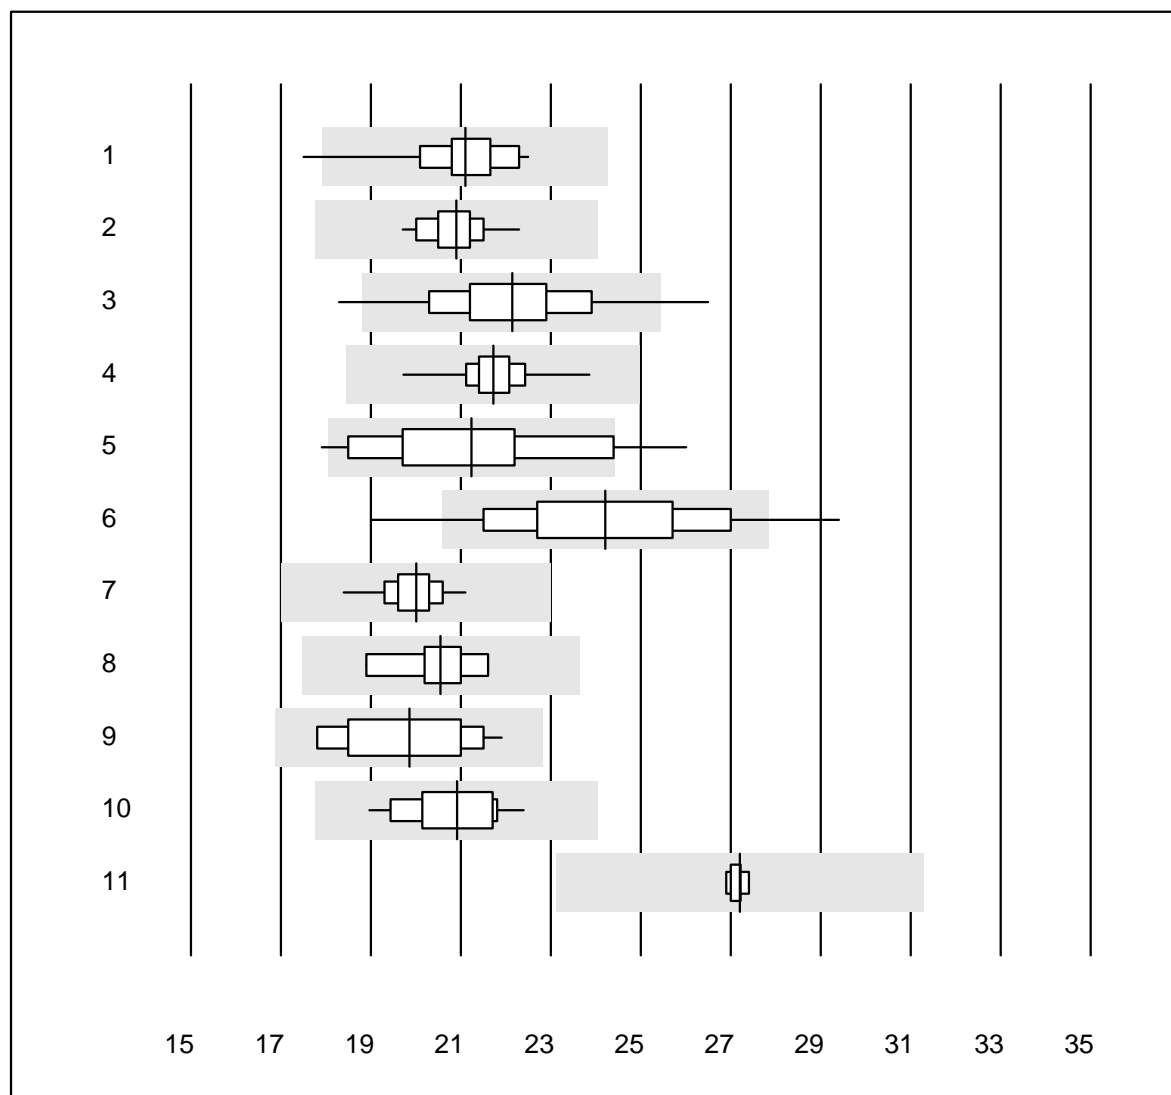


QUALAB Tolérance : 15 %

Urée (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	Chimie humide	27	96.3	3.7	0.0	21.1	4.9	e
2	Cobas	20	100.0	0.0	0.0	20.9	3.1	e
3	Reflotron	170	92.4	3.5	4.1	22.1	6.6	e
4	Fuji Dri-Chem	573	99.0	0.0	1.0	21.7	2.5	e
5	Spotchem SP-4430	42	80.9	14.3	4.8	21.2	9.7	e
6	Spotchem D-Concept	236	88.5	8.5	3.0	24.2	8.8	e
7	Piccolo	63	98.4	0.0	1.6	20.0	2.9	e
8	Skyla	6	100.0	0.0	0.0	20.6	4.5	e*
9	Selectra Pro	11	90.9	0.0	9.1	19.9	7.2	e*
10	Autolyser/DiaSys	14	100.0	0.0	0.0	20.9	4.7	e
11	iStat Chem8	5	100.0	0.0	0.0	27.2	0.7	e

Potassium

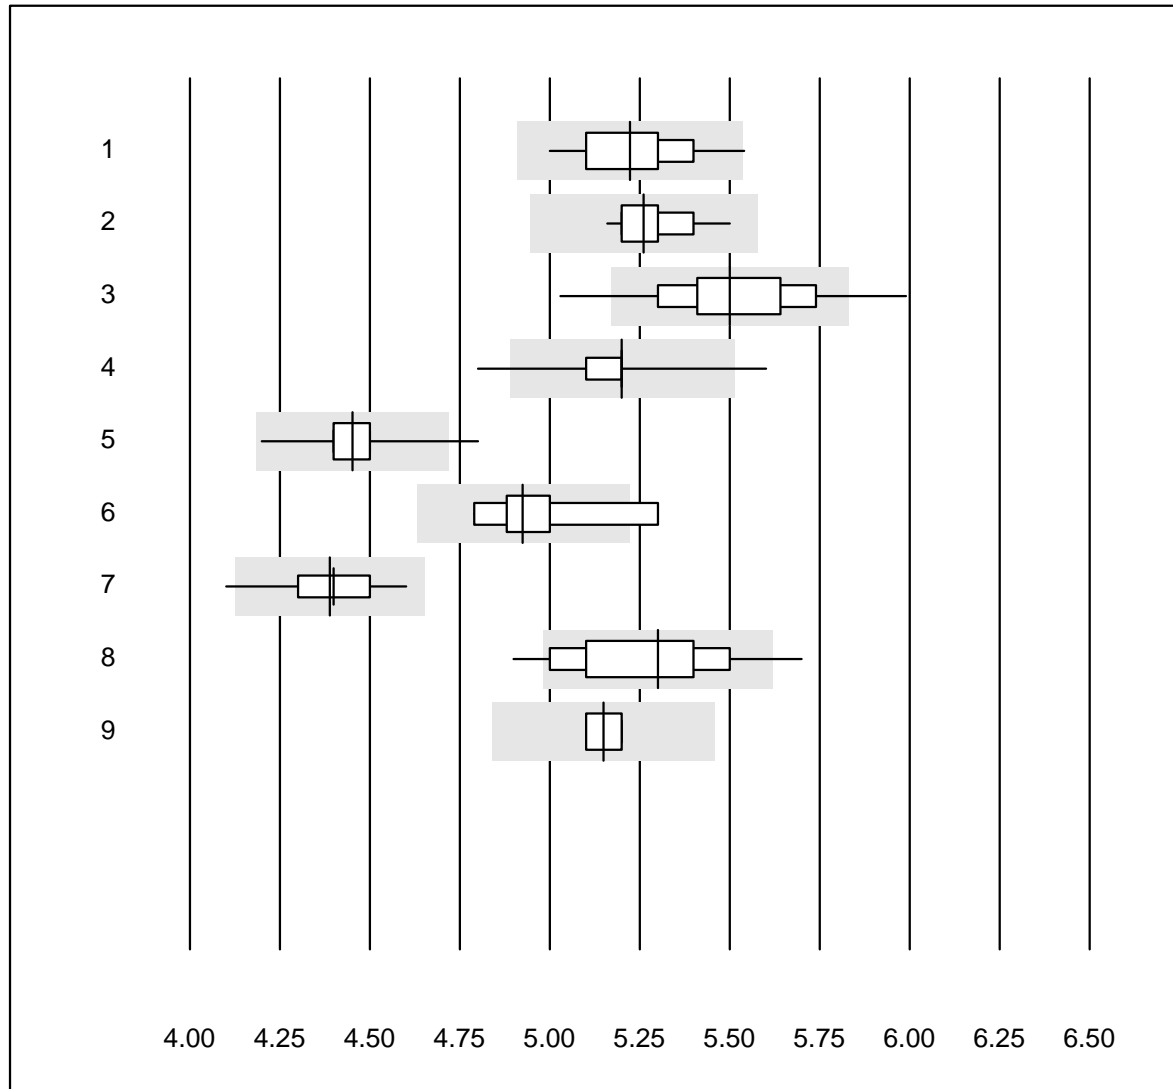


QUALAB Tolérance : 6 %

Potassium (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 ISE	38	97.4	2.6	0.0	5.22	2.4	e
2 Cobas	22	100.0	0.0	0.0	5.26	1.8	e
3 Reflotron	370	88.6	6.8	4.6	5.50	3.2	e
4 Fuji Dri-Chem	995	97.4	1.1	1.5	5.20	1.6	e
5 Spotchem D-Concept	401	98.6	0.2	1.2	4.45	1.9	e
6 Autolyser/DiaSys	6	66.6	16.7	16.7	4.93	3.9	e*
7 Spotchem EL-SE 1520	67	92.5	3.0	4.5	4.39	2.2	e
8 Piccolo	47	83.0	6.4	10.6	5.30	3.6	e
9 iStat Chem8	8	100.0	0.0	0.0	5.15	1.0	e

Créatinine

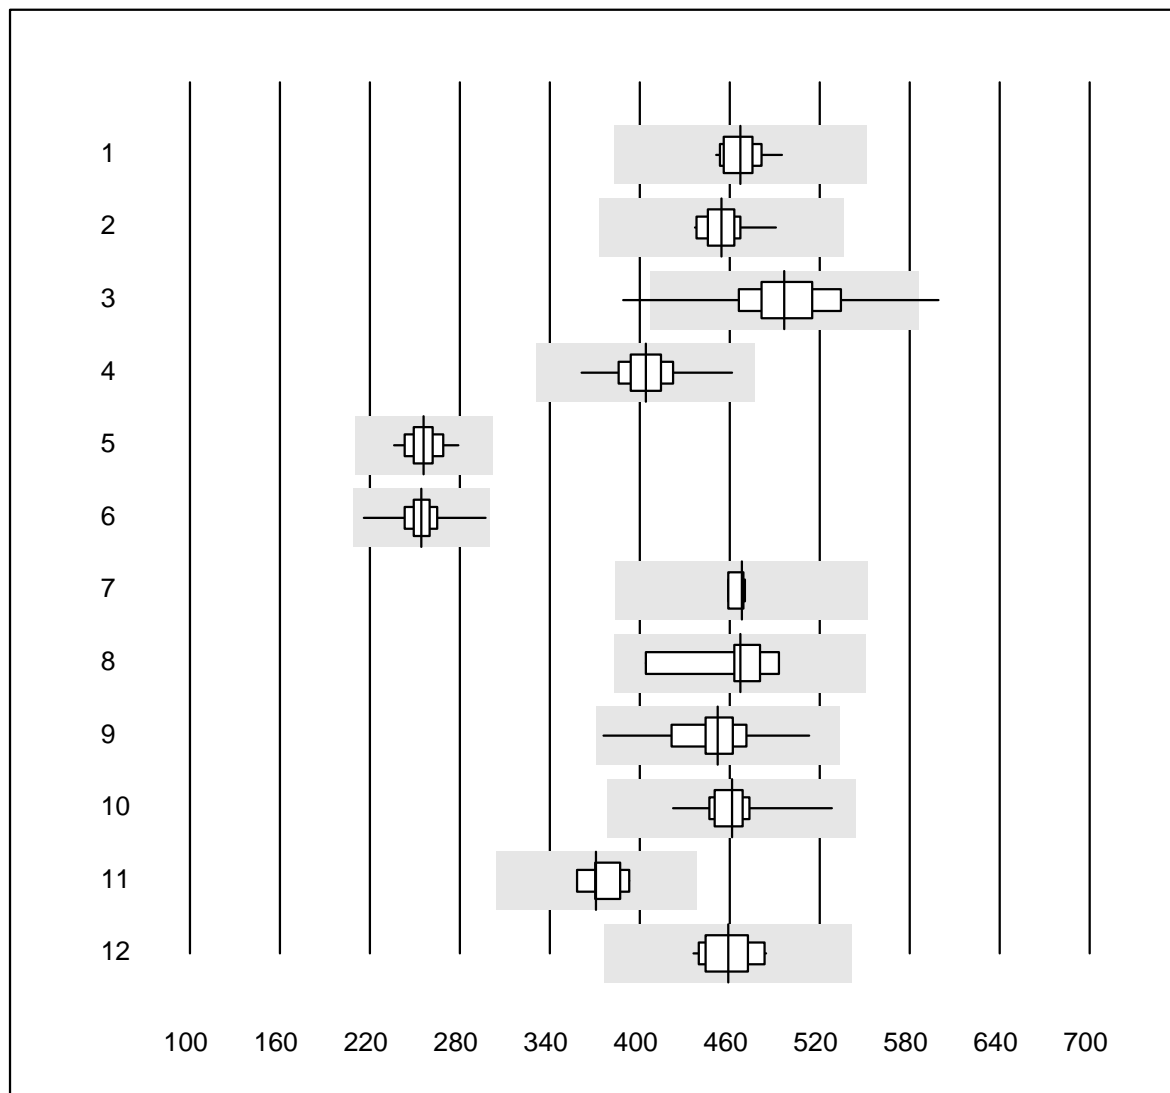


QUALAB Tolérance : 18 %

Créatinine (µmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	12	100.0	0.0	0.0	467	2.8	e
2 Cobas	21	100.0	0.0	0.0	455	2.8	e
3 Reflotron	526	94.5	2.1	3.4	497	6.1	e
4 Fuji Dri-Chem	1036	99.1	0.0	0.9	404	3.5	e
5 Spotchem SP-4430	93	98.9	0.0	1.1	256	3.7	e
6 Spotchem D-Concept	424	100.0	0.0	0.0	254	3.7	e
7 Jaffé Boehringer	4	100.0	0.0	0.0	468	1.0	e
8 Enzymatisch	9	100.0	0.0	0.0	467	5.5	e
9 Piccolo	70	100.0	0.0	0.0	452	4.6	e
10 Selectra Pro	20	95.0	0.0	5.0	461	4.3	e
11 Skyla	5	100.0	0.0	0.0	371	3.8	e
12 Autolyser/DiaSys	20	95.0	0.0	5.0	459	3.3	e
13 Autres méthodes	5	100.0	0.0	0.0	479	3.6	e
14 EPOC	10	90.0	0.0	10.0	475	5.2	e

Créatinine E

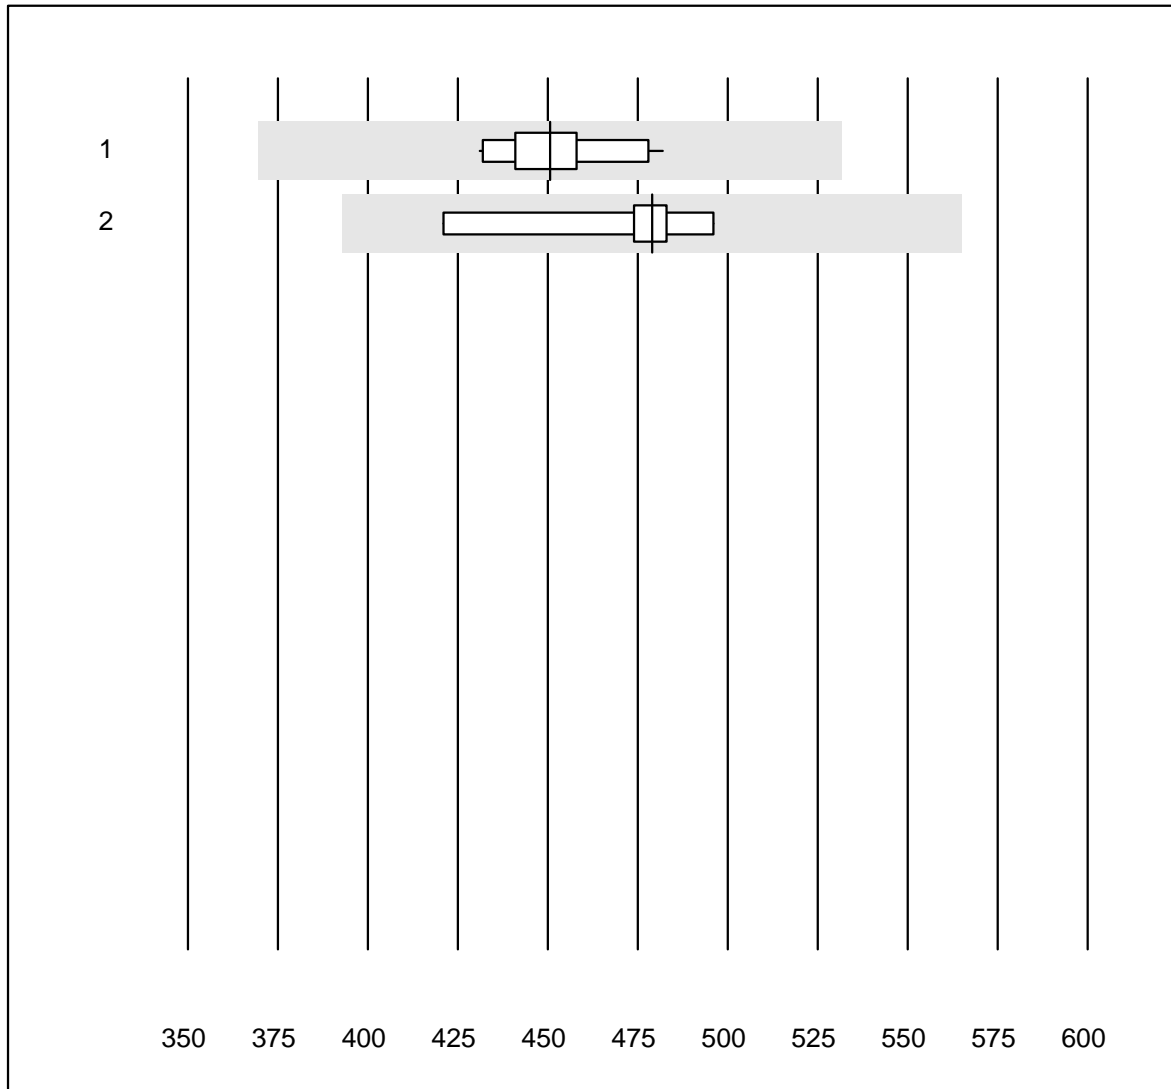


QUALAB Tolérance : 18 %

Créatinine E (µmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 iStat Chem8	13	100.0	0.0	0.0	451	3.7	e
2 ABL700/800	8	100.0	0.0	0.0	479	4.9	e

eGFR CKD-EPI

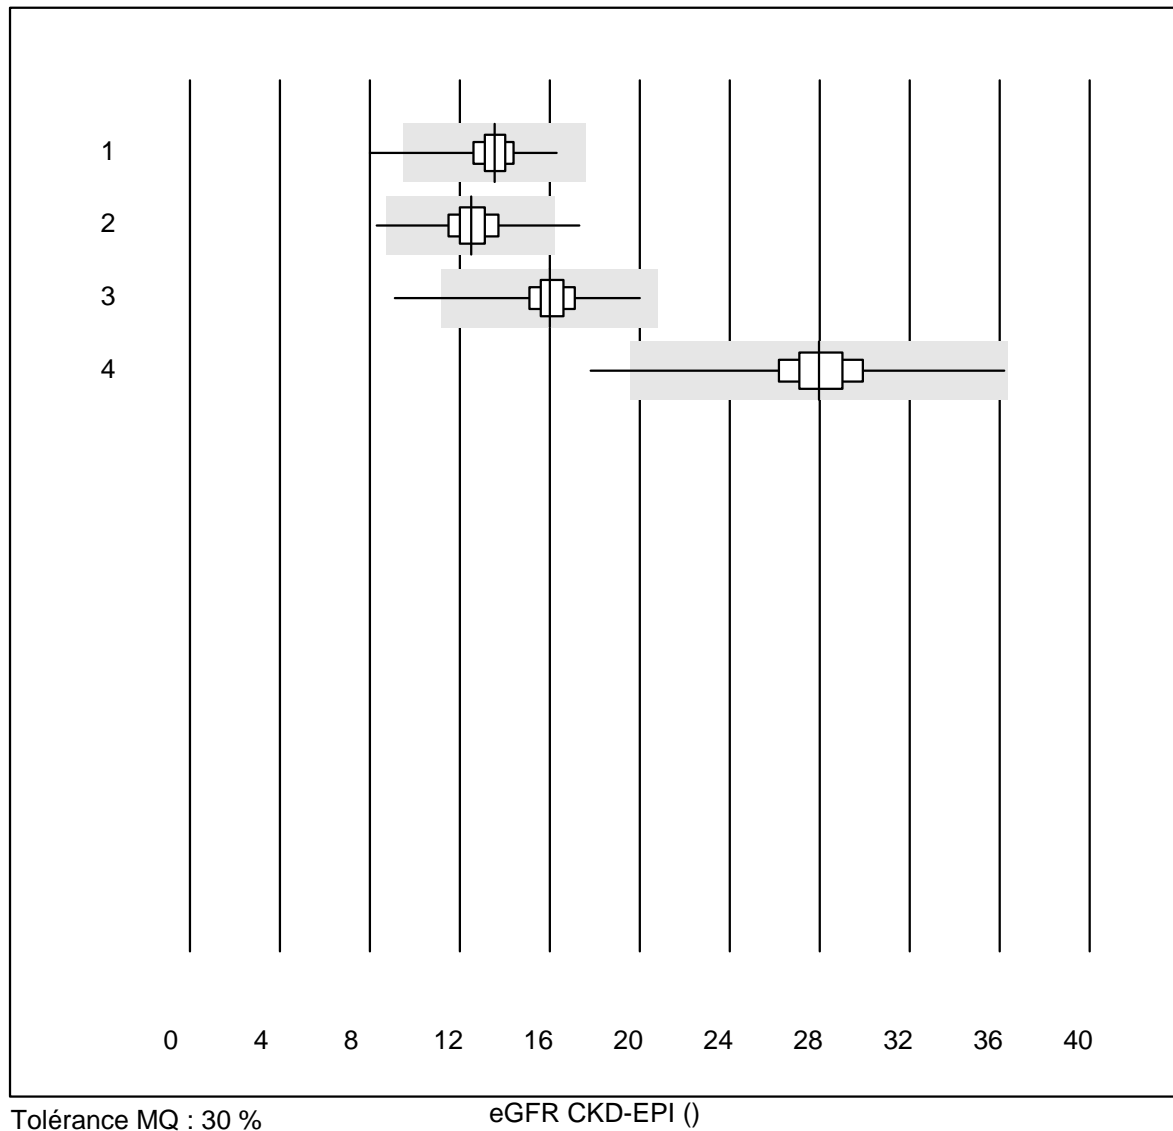


Tolérance MQ : 30 %

eGFR CKD-EPI ()


No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	Chimie humide	64	90.6	3.1	6.3	14	9.6	e
2	Reflotron	147	94.5	1.4	4.1	13	9.4	e
3	Fuji Dri-Chem	389	95.6	1.3	3.1	16	7.4	e
4	Spotchem	186	95.1	1.1	3.8	28	7.7	e

eGFR Cockcroft-Gault

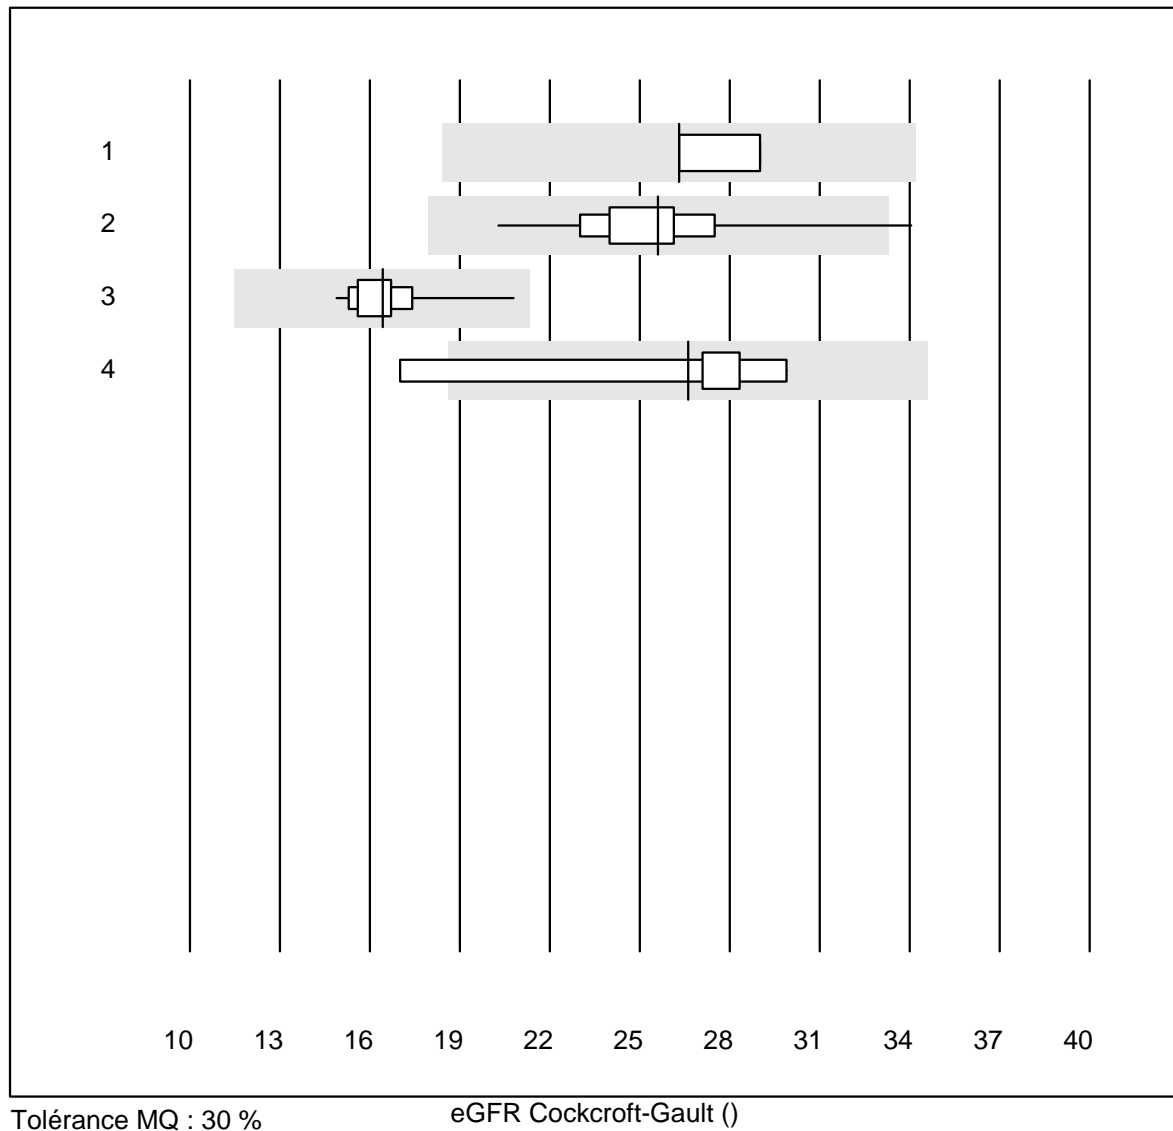

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	4	75.0	0.0	25.0	26	5.7	e
2 Reflotron	16	74.9	6.3	18.8	26	12.4	e
3 Fuji Dri-Chem	34	50.0	0.0	50.0	16	8.0	e
4 Spotchem	12	58.4	8.3	33.3	27	15.0	e*

eGFR MDRD

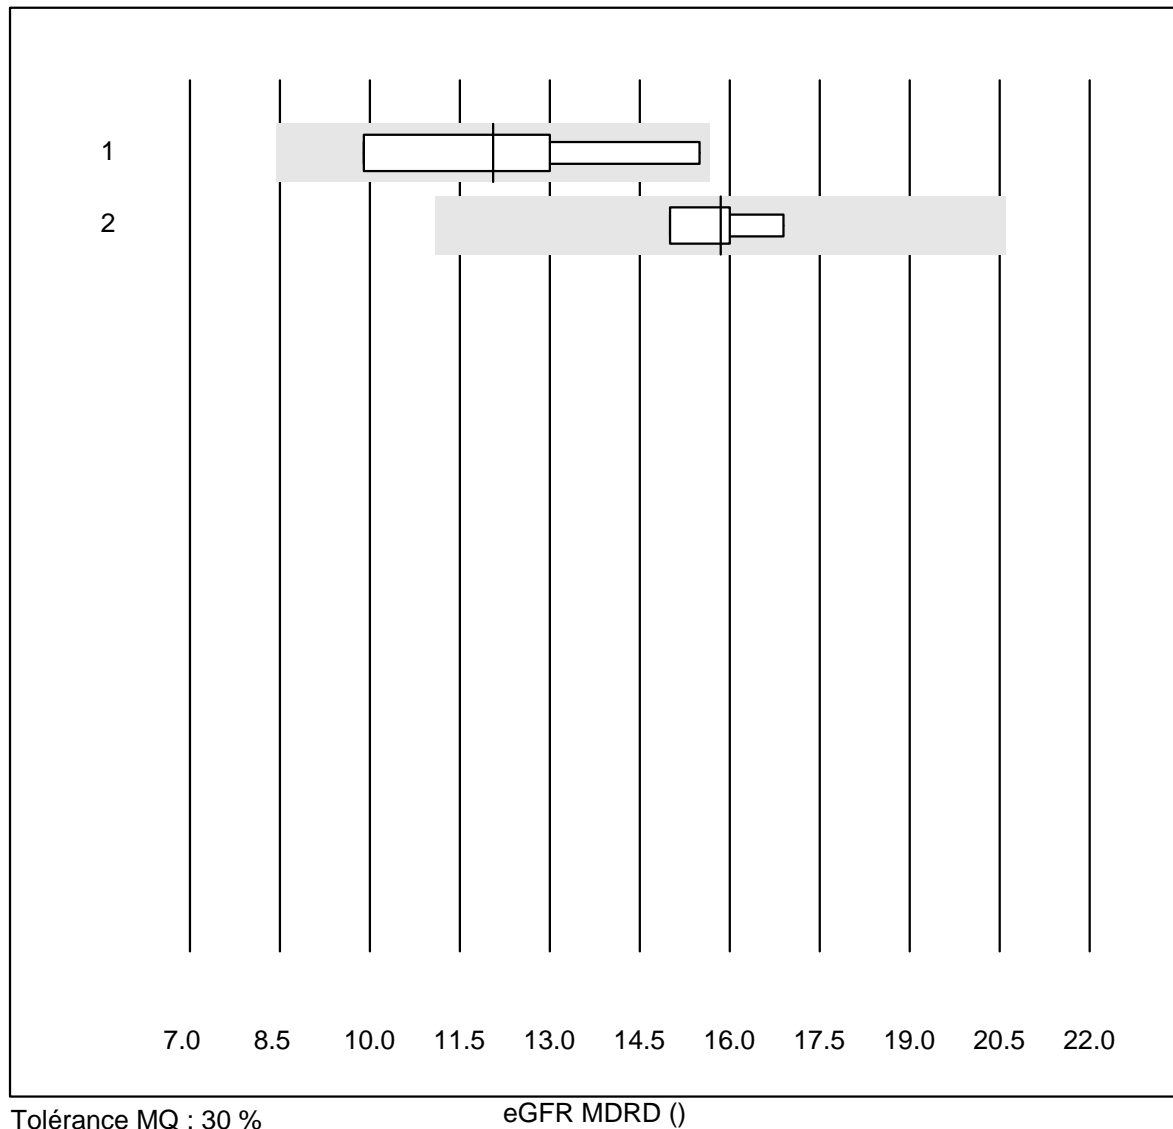


Tolérance MQ : 30 %

eGFR MDRD ()


No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Reflotron	4	100.0	0.0	0.0	12	19.7	e*
2 Fuji Dri-Chem	4	100.0	0.0	0.0	16	5.0	e

LDH

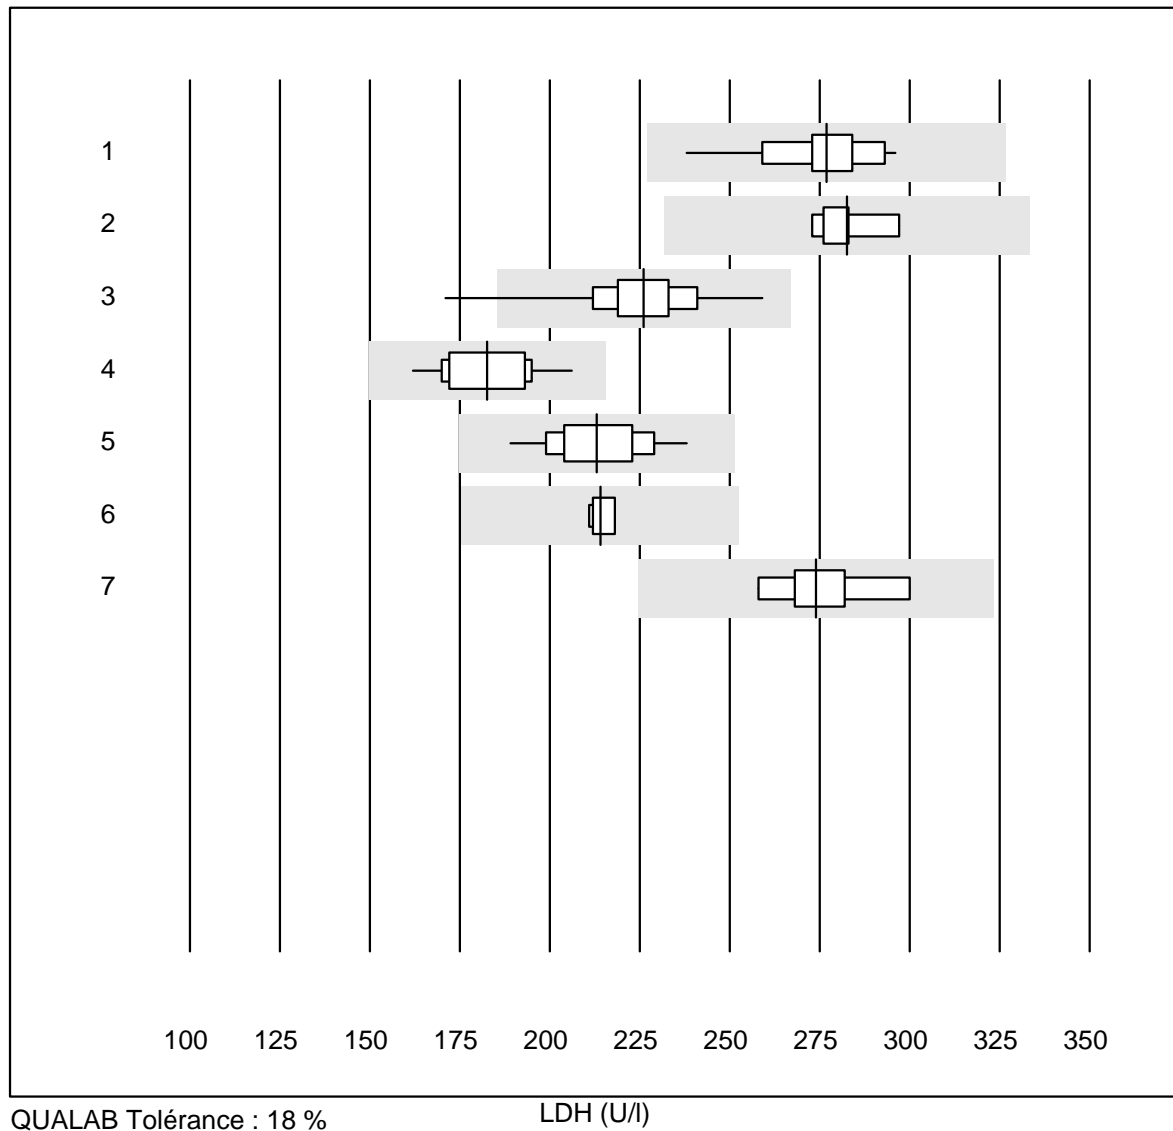

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 IFCC	36	100.0	0.0	0.0	277	4.8	e
2 Cobas	8	100.0	0.0	0.0	283	2.5	e
3 Fuji Dri-Chem	147	95.2	0.7	4.1	226	5.5	e
4 Spotchem SP-4430	12	91.7	0.0	8.3	183	6.8	e
5 Spotchem D-Concept	45	97.8	0.0	2.2	213	5.9	e
6 Piccolo	5	100.0	0.0	0.0	214	1.5	e
7 Autolyser/DiaSys	9	100.0	0.0	0.0	274	4.7	e

Magnésium

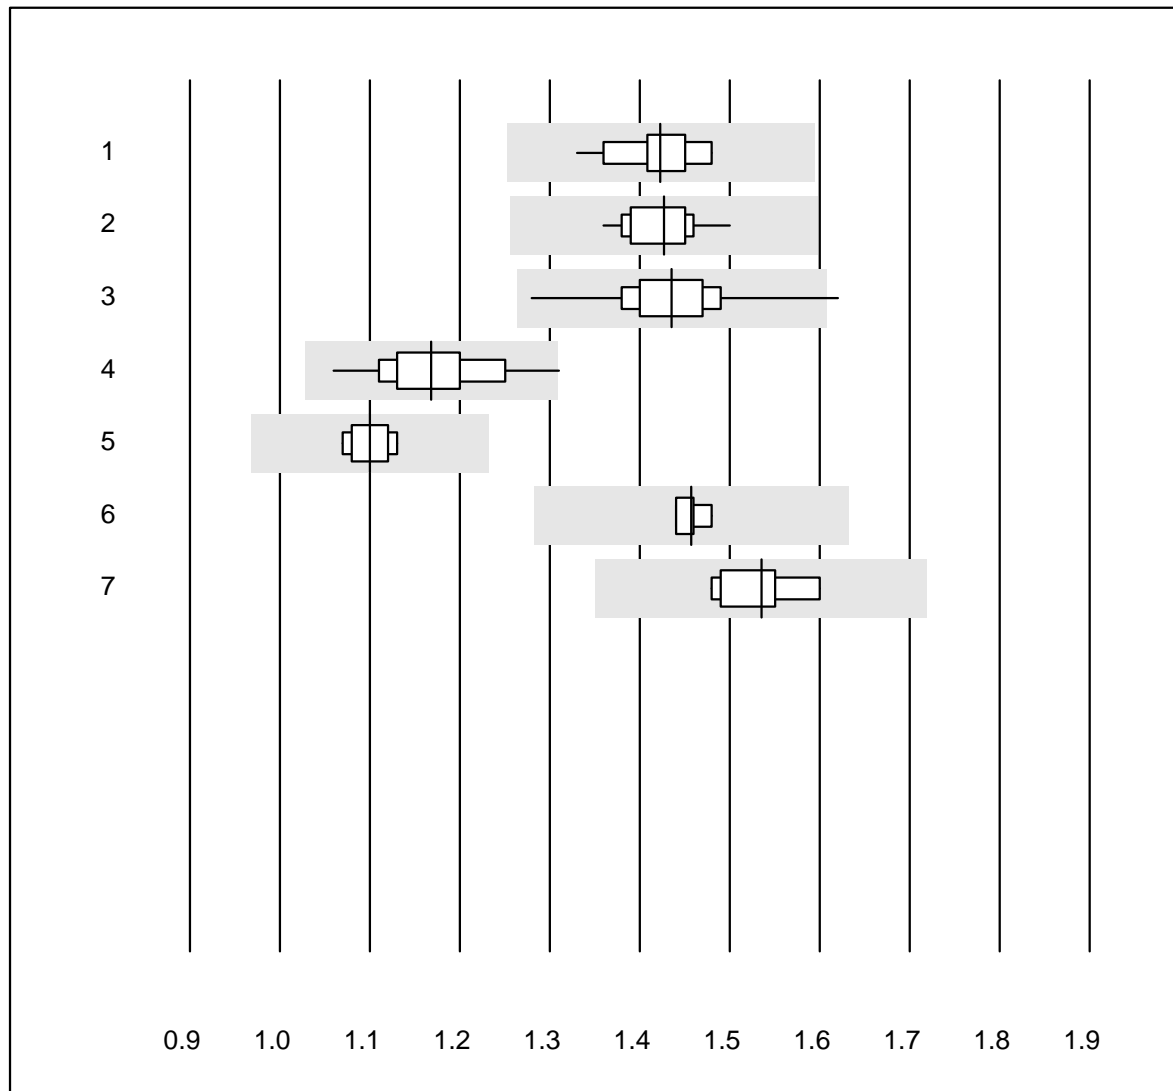


QUALAB Tolérance : 12 %

Magnésium (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	20	100.0	0.0	0.0	1.42	2.8	e
2 Cobas	15	100.0	0.0	0.0	1.43	2.5	e
3 Fuji Dri-Chem	104	96.2	1.9	1.9	1.44	3.7	e
4 Spotchem D-Concept	42	97.6	2.4	0.0	1.17	4.7	e
5 Spotchem SP-4430	5	100.0	0.0	0.0	1.10	2.3	e
6 Beckman	4	100.0	0.0	0.0	1.46	1.1	e
7 Piccolo	6	100.0	0.0	0.0	1.54	2.9	e

Sodium

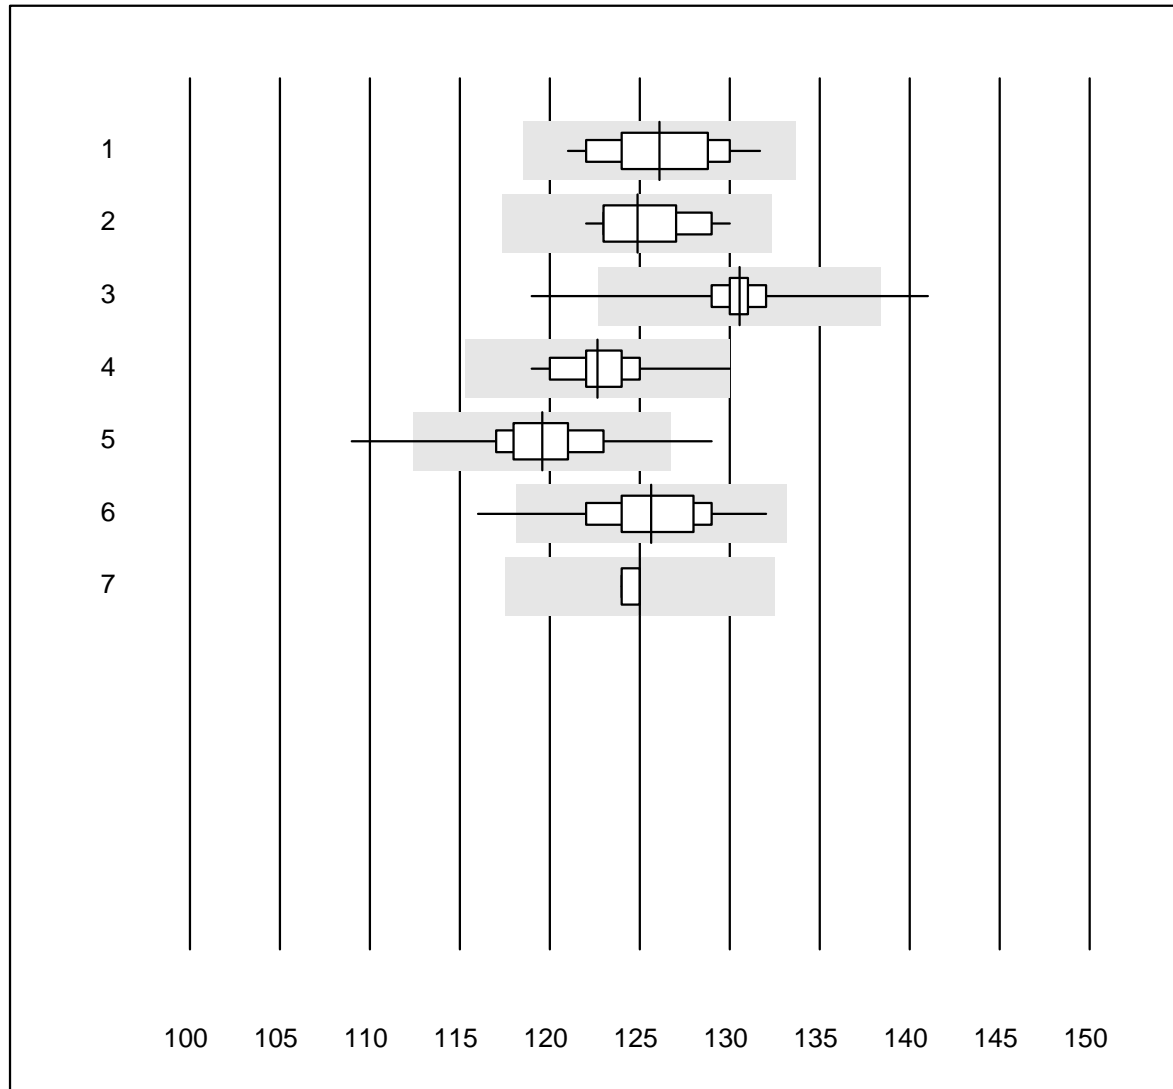


QUALAB Tolérance : 6 %

Sodium (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 ISE	38	100.0	0.0	0.0	126	2.2	e
2 Cobas	22	100.0	0.0	0.0	125	2.0	e
3 Fuji Dri-Chem	914	97.5	1.6	0.9	131	1.6	e
4 Spotchem D-Concept	367	98.9	0.0	1.1	123	1.4	e
5 Spotchem EL-SE 1520	64	92.2	4.7	3.1	120	2.6	e
6 Piccolo	46	97.8	2.2	0.0	126	2.5	e
7 iStat Chem8	7	100.0	0.0	0.0	125	0.4	e

Phosphates

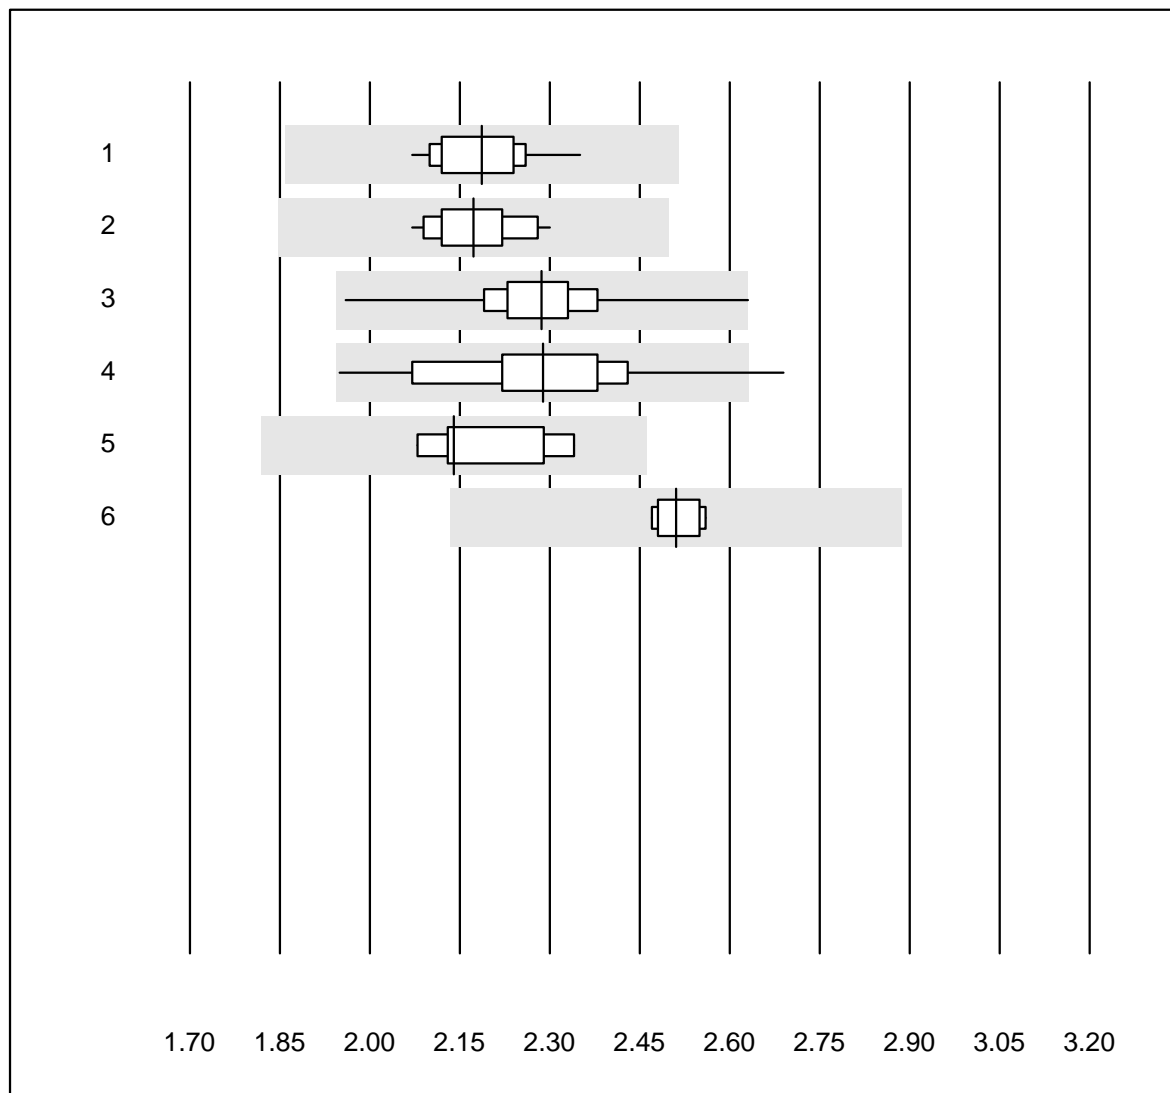


QUALAB Tolérance : 15 %

Phosphates (mmol/l)


No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	Chimie humide	22	100.0	0.0	0.0	2.2	3.3	e
2	Cobas	18	100.0	0.0	0.0	2.2	3.0	e
3	Fuji Dri-Chem	84	97.6	1.2	1.2	2.3	4.2	e
4	Spotchem D-Concept	18	88.8	5.6	5.6	2.3	7.1	e
5	Spotchem SP-4430	5	100.0	0.0	0.0	2.1	5.1	e*
6	Piccolo	8	100.0	0.0	0.0	2.5	1.4	e

Protéine

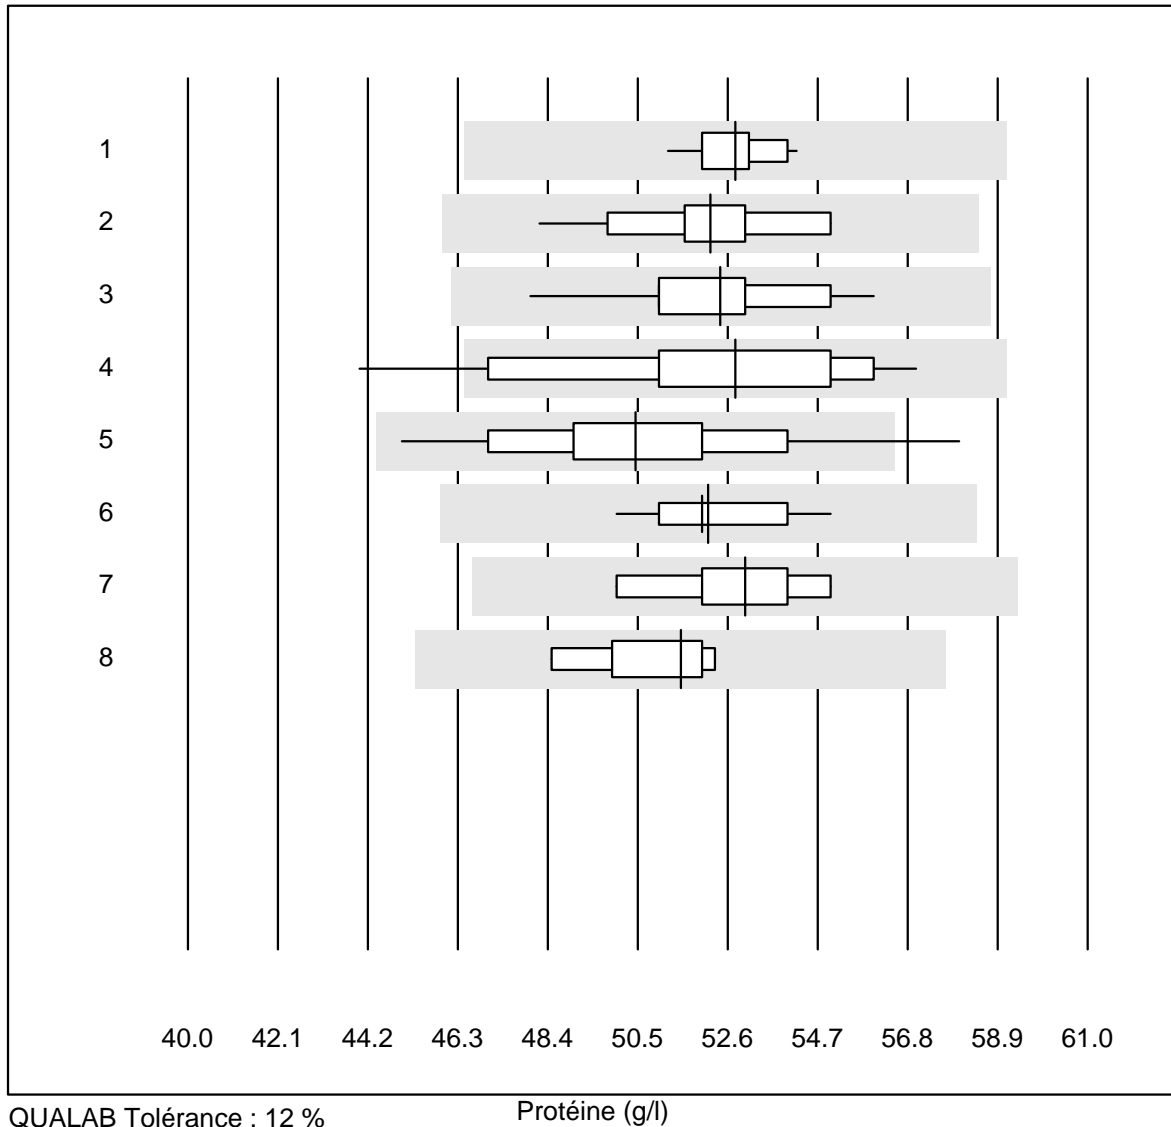

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	23	100.0	0.0	0.0	52.8	1.5	e
2 Cobas	18	100.0	0.0	0.0	52.2	3.6	e
3 Fuji Dri-Chem	187	99.5	0.0	0.5	52.4	2.9	e
4 Spotchem SP-4430	27	96.3	3.7	0.0	52.8	6.5	e
5 Spotchem D-Concept	138	96.4	2.2	1.4	50.4	5.8	e
6 Piccolo	49	95.9	0.0	4.1	52.1	2.0	e
7 Skyla	5	100.0	0.0	0.0	53.0	3.6	e*
8 Selectra Pro	9	88.9	0.0	11.1	51.5	2.5	e

Transaminase GOT/AST

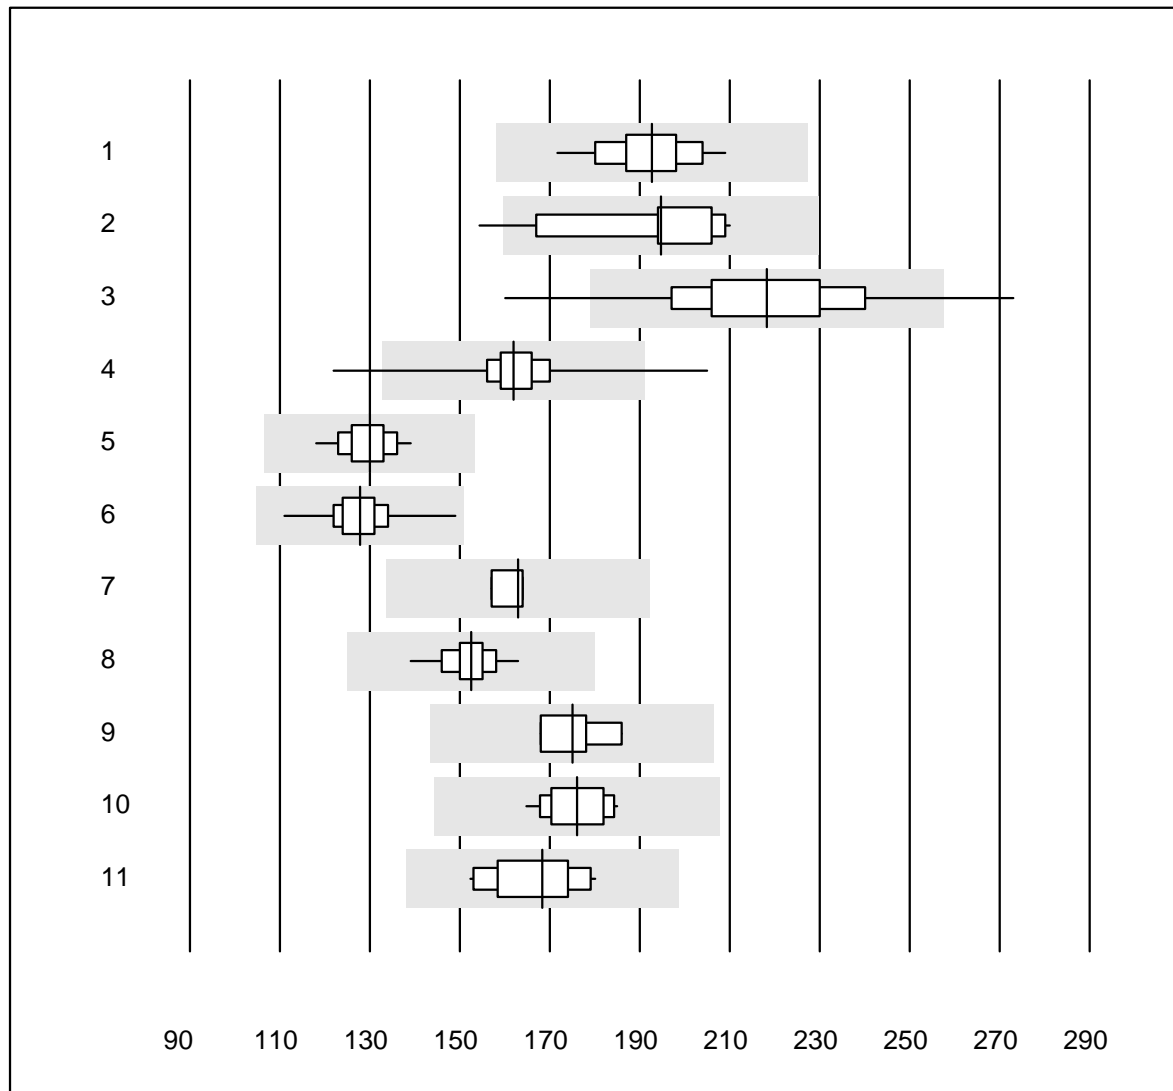


QUALAB Tolérance : 18 %

Transaminase GOT/AST (U/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 IFCC avec PP	27	100.0	0.0	0.0	193	4.8	e
2 Cobas	19	94.7	5.3	0.0	195	8.6	e
3 Reflotron	442	91.7	4.5	3.8	218	8.1	e
4 Fuji Dri-Chem	1021	98.5	0.7	0.8	162	4.2	e
5 Spotchem SP-4430	91	100.0	0.0	0.0	130	3.8	e
6 Spotchem D-Concept	421	100.0	0.0	0.0	128	4.0	e
7 IFCC sens PP	4	100.0	0.0	0.0	163	2.0	e
8 Piccolo	74	100.0	0.0	0.0	152	3.1	e
9 Skyla	6	100.0	0.0	0.0	175	3.9	e
10 Selectra Pro	18	94.4	0.0	5.6	176	3.7	e
11 Autolyser/DiaSys	20	100.0	0.0	0.0	168	5.3	e

Transaminase GPT/ALT

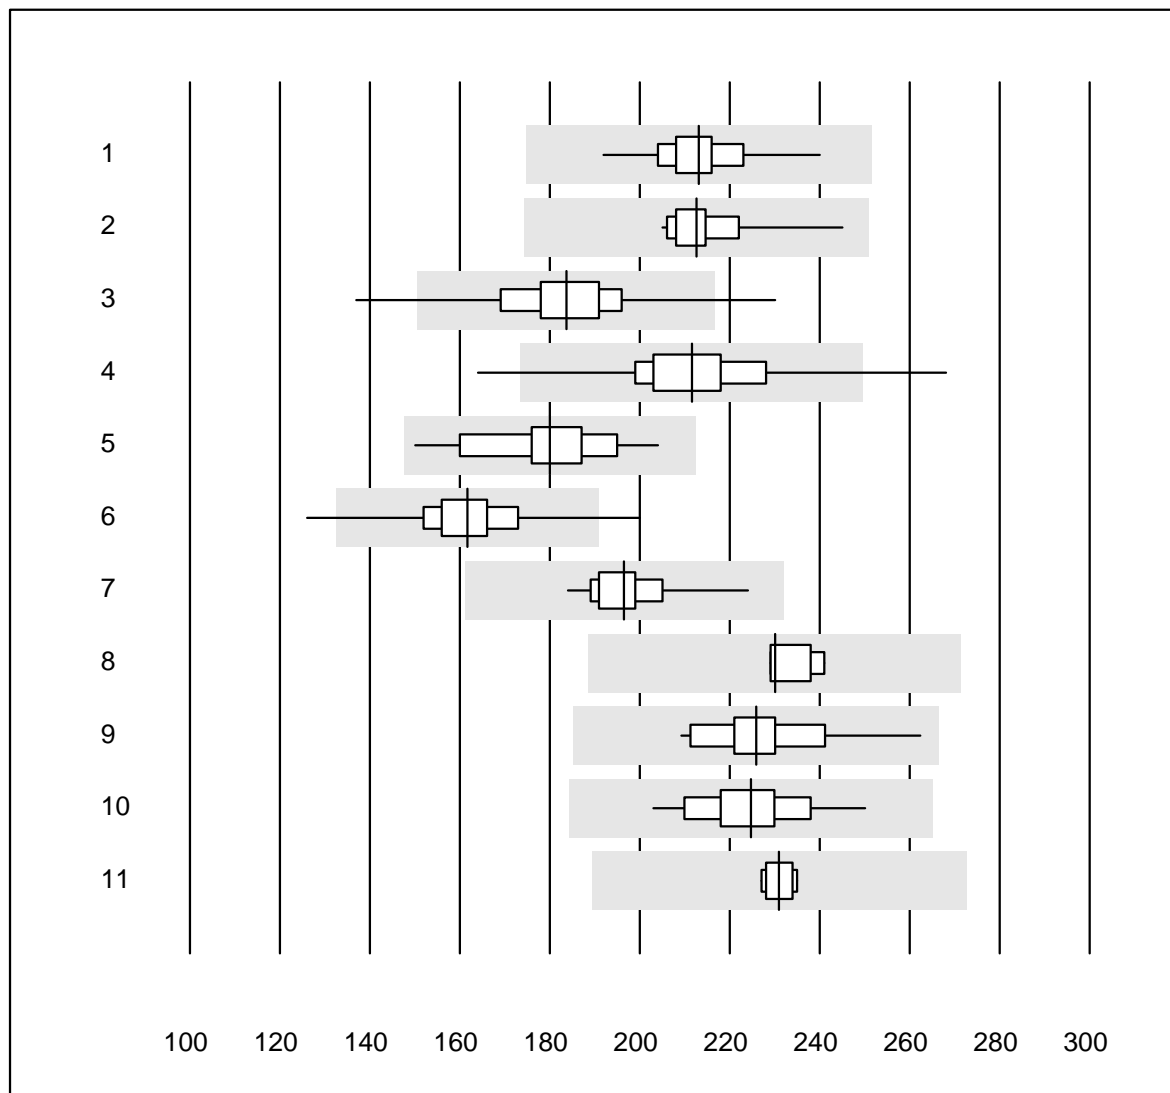


QUALAB Tolérance : 18 %

Transaminase GPT/ALT (U/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 IFCC avec PP	22	100.0	0.0	0.0	213	4.5	e
2 Cobas	23	100.0	0.0	0.0	213	4.0	e
3 Reflotron	451	96.4	2.0	1.6	184	6.5	e
4 Fuji Dri-Chem	1033	97.5	1.4	1.1	212	5.8	e
5 Spotchem SP-4430	93	100.0	0.0	0.0	180	6.9	e
6 Spotchem D-Concept	426	98.1	1.4	0.5	162	5.6	e
7 Piccolo	72	100.0	0.0	0.0	197	3.8	e
8 Skyla	6	100.0	0.0	0.0	230	2.3	e
9 Selectra Pro	18	94.4	0.0	5.6	226	5.5	e
10 Autolyser/DiaSys	20	100.0	0.0	0.0	225	5.1	e
11 Autres méthodes	5	100.0	0.0	0.0	231	1.5	e

Triglycérides

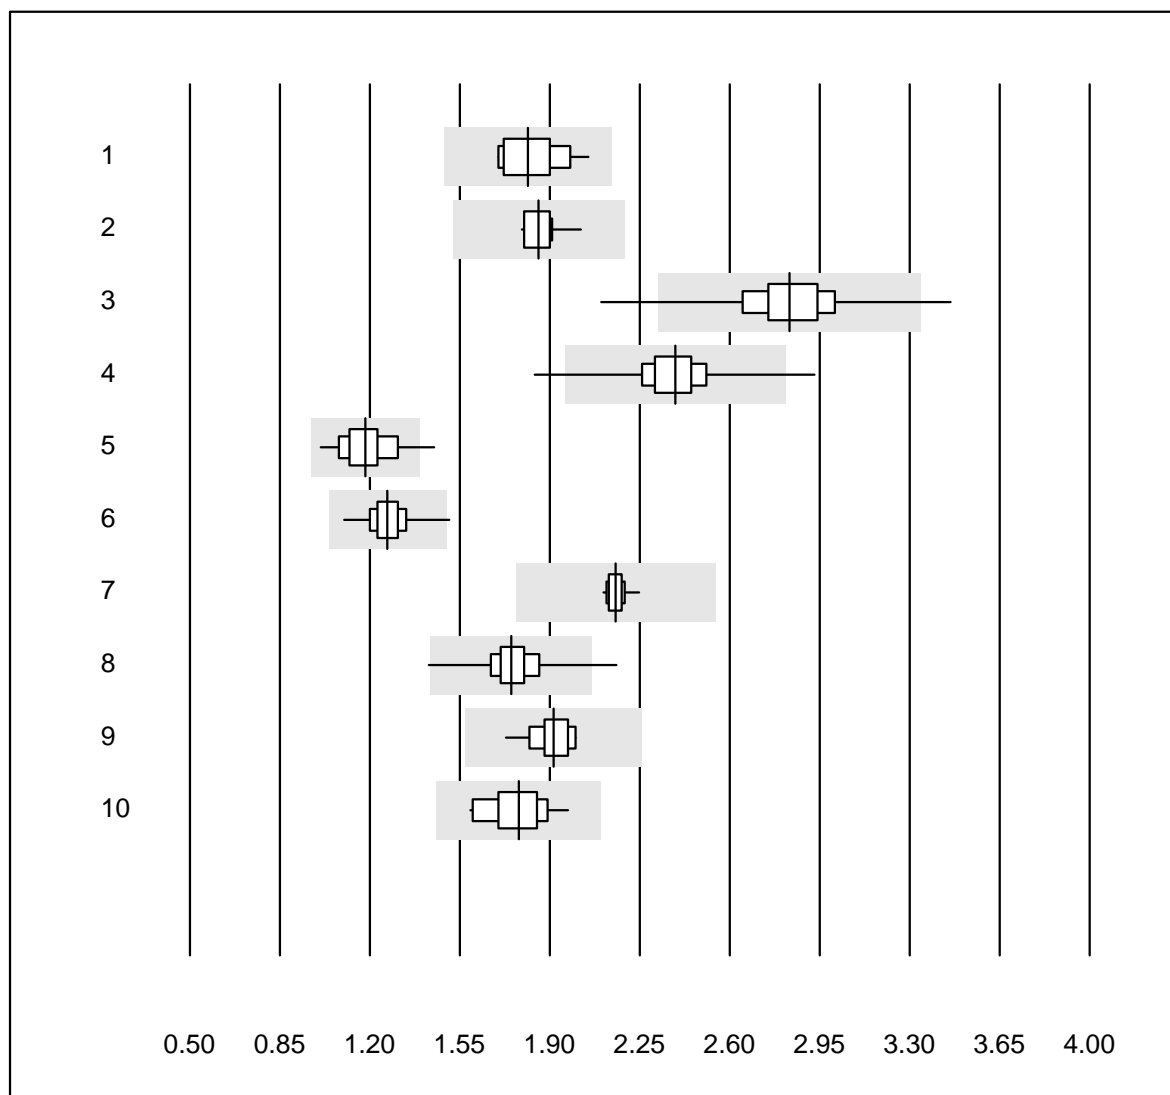


QUALAB Tolérance : 18 %

Triglycérides (mmol/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	25	96.0	0.0	4.0	1.81	5.9	e
2 Cobas	22	100.0	0.0	0.0	1.86	3.2	e
3 Reflotron	111	88.3	4.5	7.2	2.83	7.3	e
4 Fuji Dri-Chem	879	98.4	0.6	1.0	2.39	4.6	e
5 Spotchem SP-4430	71	97.2	1.4	1.4	1.18	7.5	e
6 Spotchem D-Concept	370	97.5	0.3	2.2	1.27	4.7	e
7 Piccolo	27	100.0	0.0	0.0	2.16	1.5	e
8 Cholestech LDX	303	98.0	1.0	1.0	1.75	4.7	e
9 Selectra Pro	14	92.9	0.0	7.1	1.91	4.1	e
10 Autolyser/DiaSys	20	100.0	0.0	0.0	1.78	6.0	e

Lithium

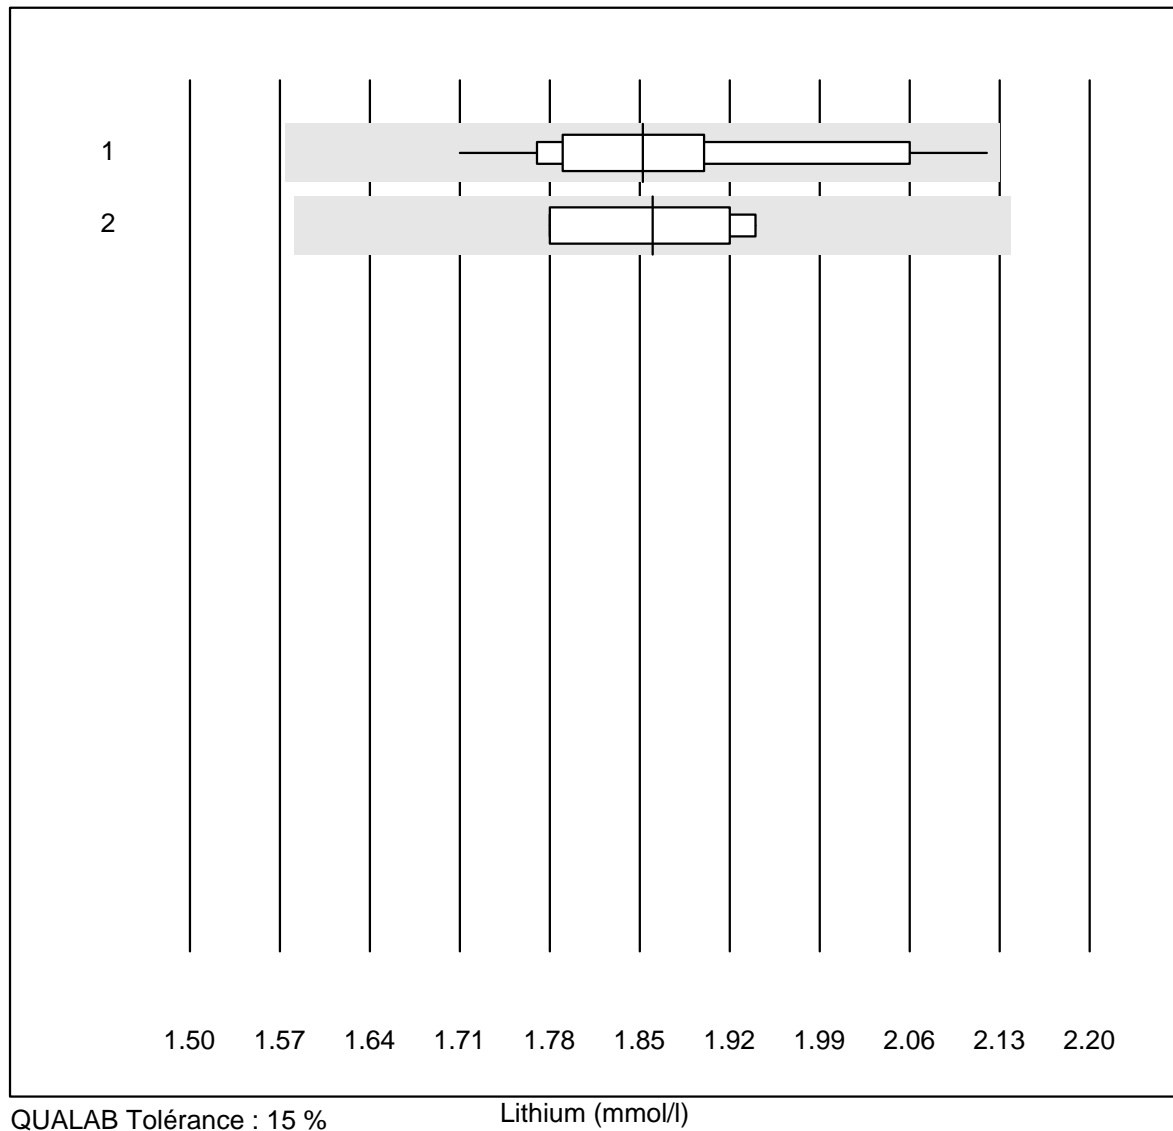


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	19	100.0	0.0	0.0	1.85	5.6	e
2 Cobas Integra 800/40	4	100.0	0.0	0.0	1.86	4.4	e*

Laktat

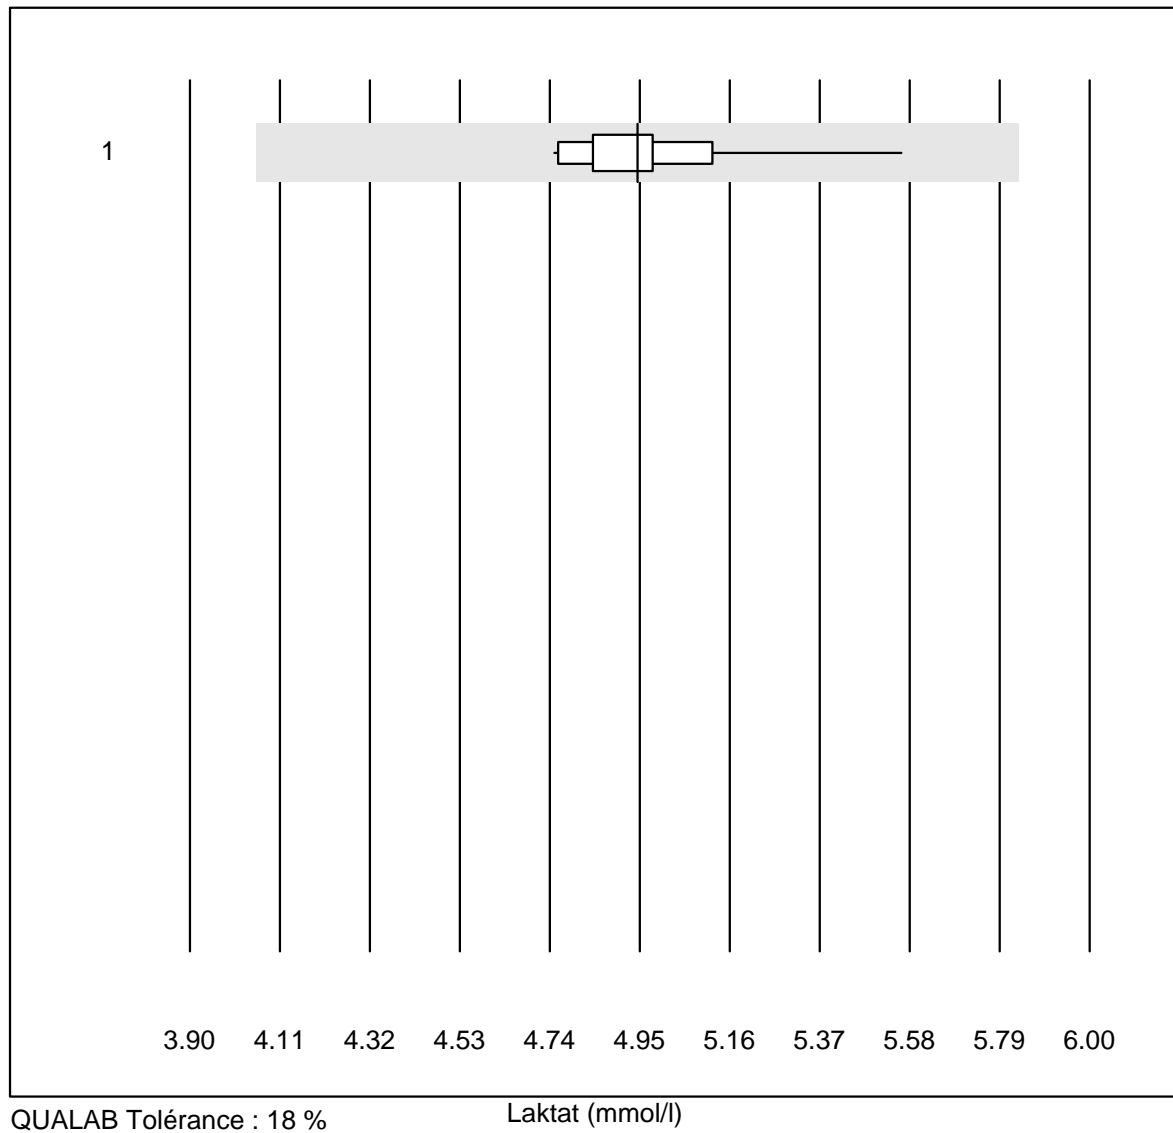

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	14	100.0	0.0	0.0	4.94	4.1	e

HbA1c échantillon A

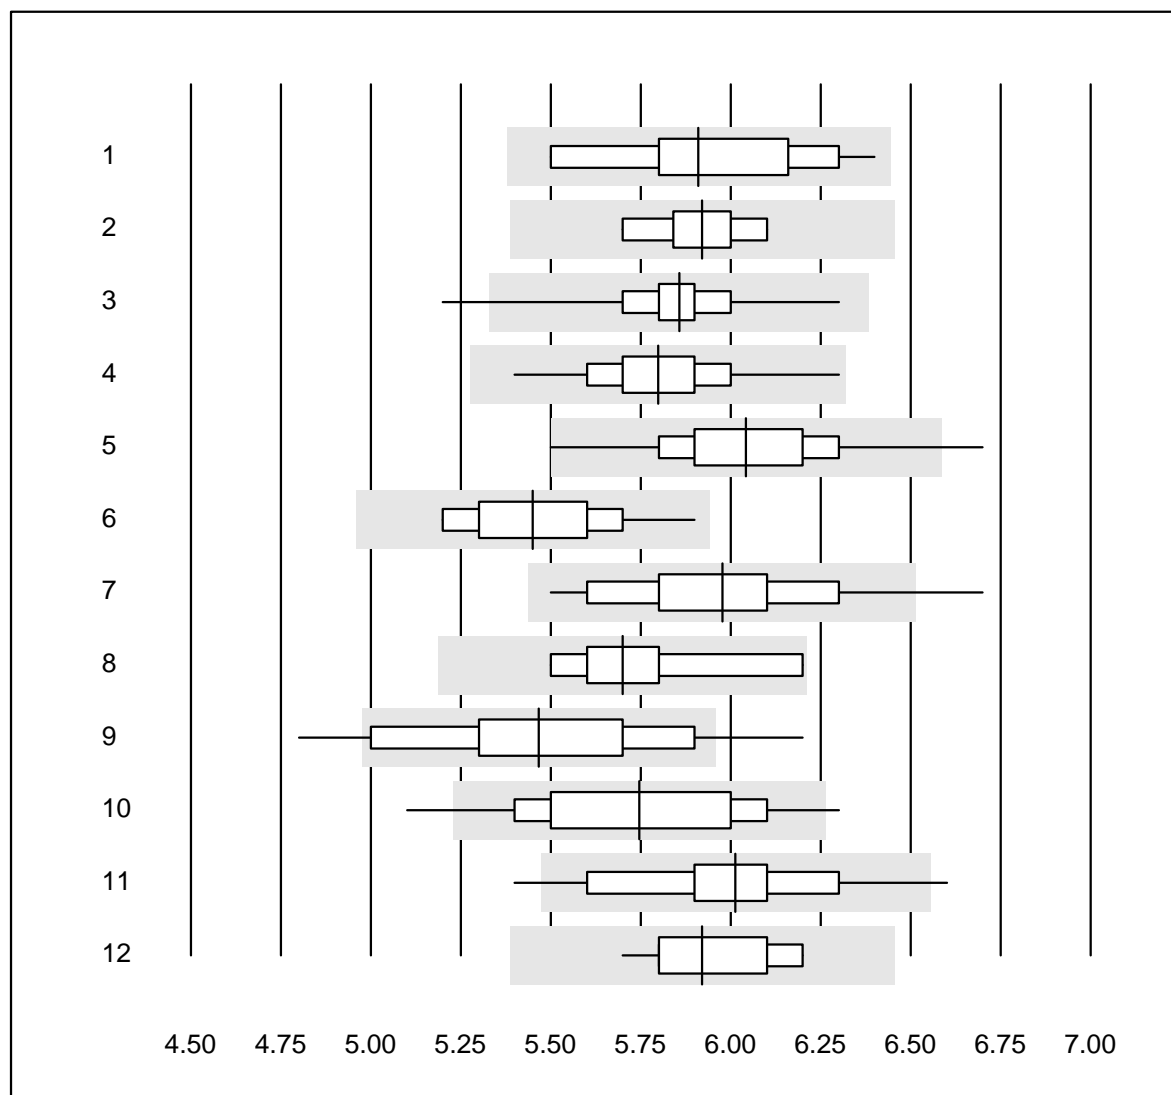


QUALAB Tolérance : 9 %

HbA1c échantillon A (%)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Roche, Cobas	15	100.0	0.0	0.0	5.9	4.5	e*
2 HPLC	8	100.0	0.0	0.0	5.9	2.3	a
3 Afinion	562	99.2	0.4	0.4	5.9	2.5	e
4 Cobas b101	149	98.7	0.0	1.3	5.8	3.1	e
5 DCA2000/Vantage	153	96.1	2.6	1.3	6.0	3.6	e
6 Celltac chemi	22	100.0	0.0	0.0	5.5	3.4	e
7 NycoCard	15	80.0	6.7	13.3	6.0	5.3	e*
8 Eurolyser	9	88.9	0.0	11.1	5.7	3.7	e*
9 A1c Now	229	84.3	11.8	3.9	5.5	5.7	e
10 AFIAS	65	90.8	4.6	4.6	5.7	5.0	e
11 Andere	24	87.5	8.3	4.2	6.0	4.7	e
12 Spinit	11	100.0	0.0	0.0	5.9	2.8	a

HbA1c échantillon B

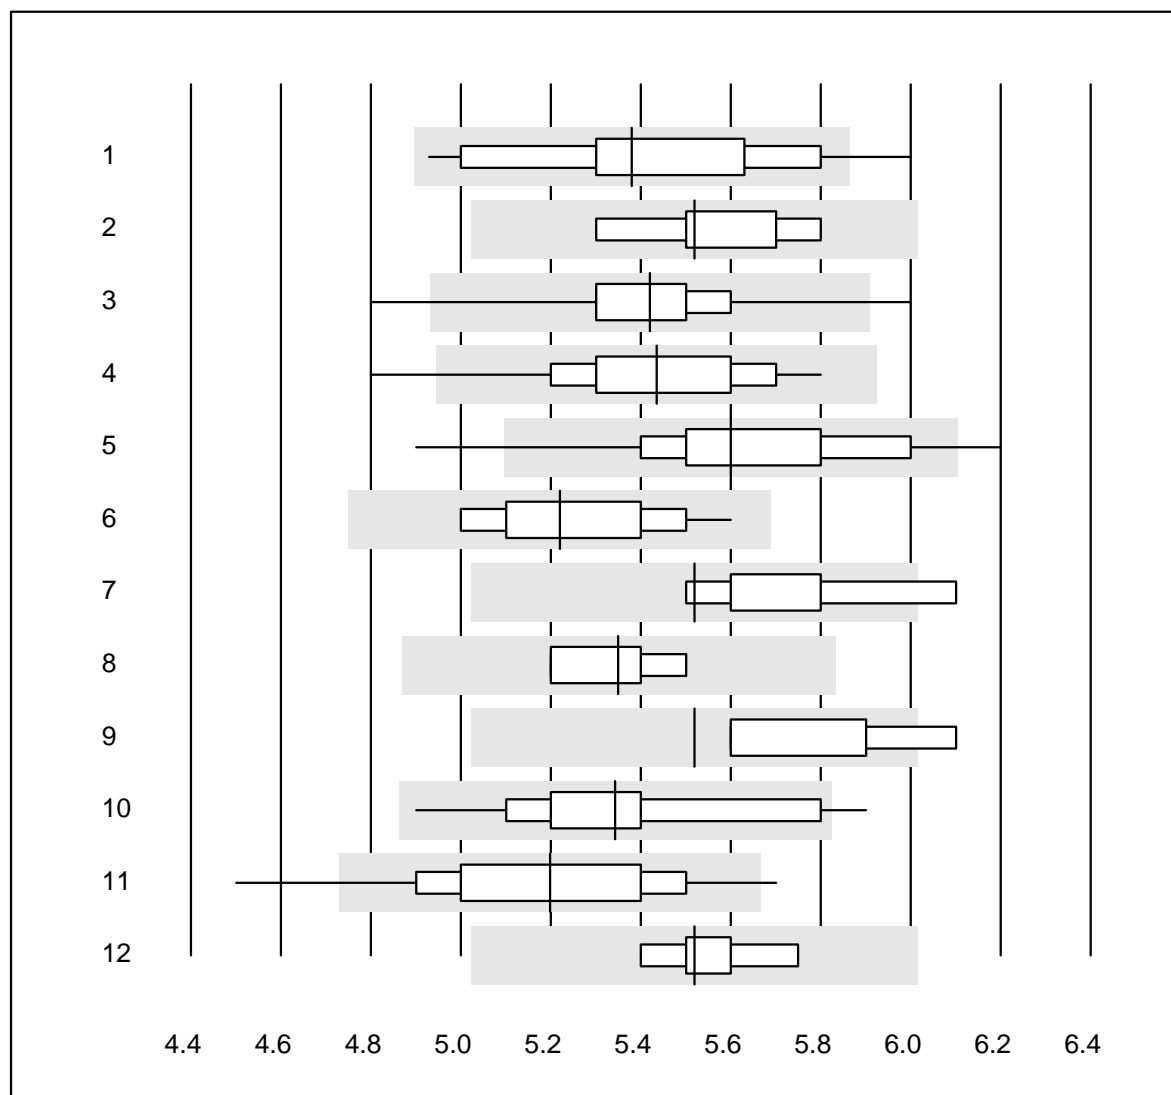


QUALAB Tolérance : 9 %

HbA1c échantillon B (%)


No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	Roche, Cobas	14	92.9	7.1	0.0	5.4	5.5	e*
2	HPLC	8	100.0	0.0	0.0	5.5	2.9	a
3	Afinion	777	99.1	0.5	0.4	5.4	2.5	e
4	Cobas b101	168	97.0	1.8	1.2	5.4	3.3	e
5	DCA2000/Vantage	229	94.3	4.4	1.3	5.6	4.3	e
6	Celltac chemi	15	100.0	0.0	0.0	5.2	3.5	e
7	NycoCard	6	66.6	16.7	16.7	5.5	4.0	a
8	Eurolyser	6	100.0	0.0	0.0	5.4	2.3	e
9	Hemocue HbA1c 501	4	75.0	25.0	0.0	5.5	3.6	a
10	A1c Now	14	92.9	7.1	0.0	5.3	5.3	e*
11	AFIAS	95	90.5	9.5	0.0	5.2	5.2	e
12	Spinit	6	100.0	0.0	0.0	5.5	2.2	a
13	Autre	18	88.9	0.0	11.1	5.5	3.2	e

pCO2

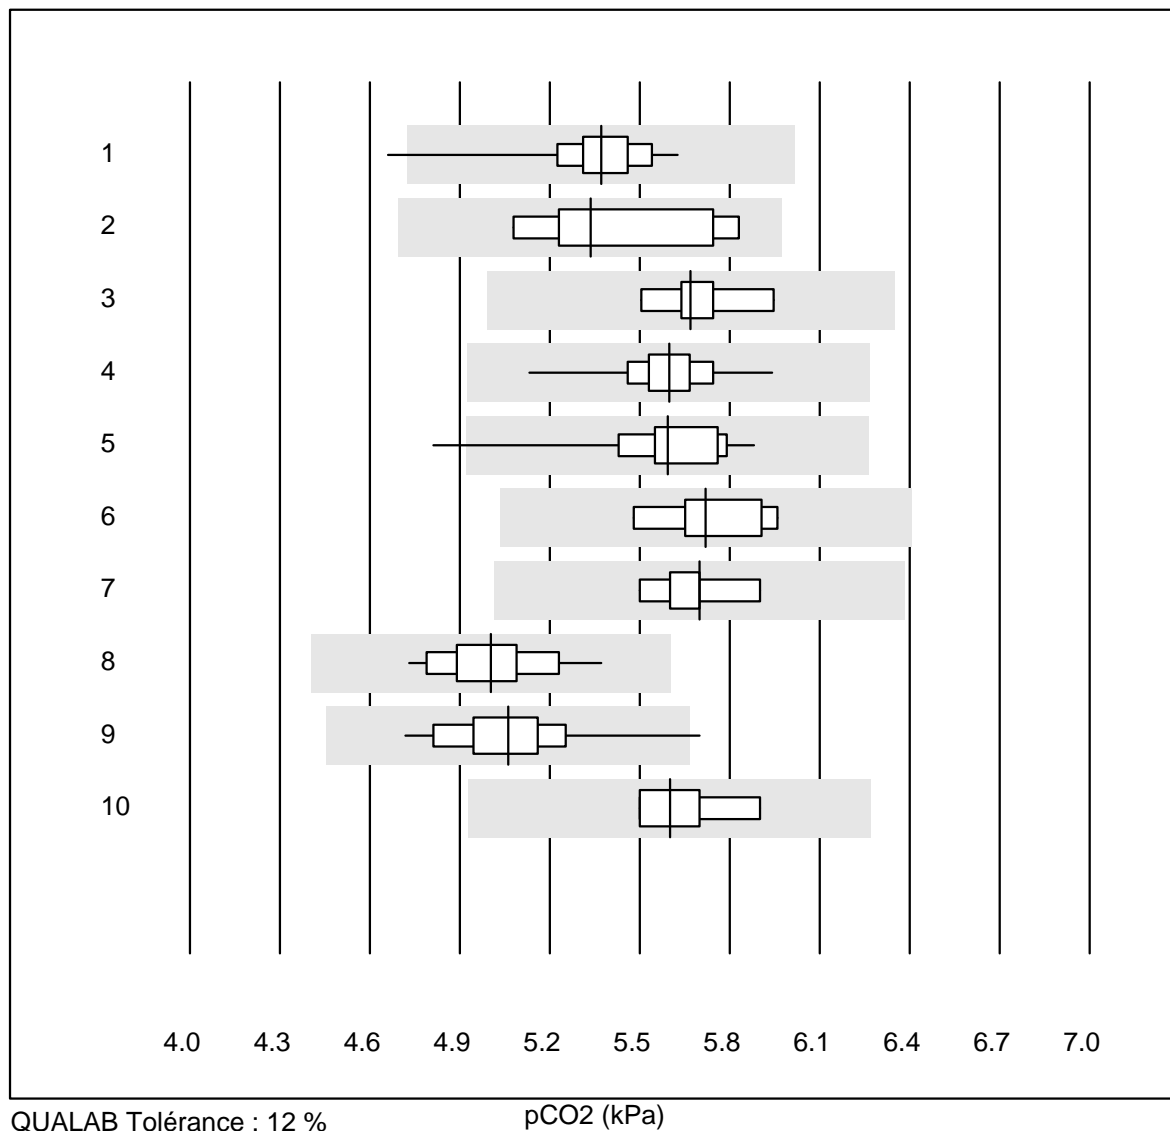

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 ABL700/800	99	99.0	1.0	0.0	5.37	2.5	e
2 ABL80 FLEX	6	100.0	0.0	0.0	5.34	5.6	e*
3 ABL80 FLEX CO-OX / O	9	88.9	0.0	11.1	5.67	2.3	e
4 ABL90 FLEX / PLUS	86	98.8	0.0	1.2	5.60	2.3	e
5 Cobas b 123	15	93.3	6.7	0.0	5.59	4.4	e
6 Cobas b 221	7	100.0	0.0	0.0	5.72	2.8	e
7 GEM	7	100.0	0.0	0.0	5.70	2.2	e
8 iStat	42	95.2	0.0	4.8	5.00	3.2	e
9 EPOC	51	94.1	2.0	3.9	5.06	3.8	e
10 IL	4	100.0	0.0	0.0	5.60	3.4	e*

pO2

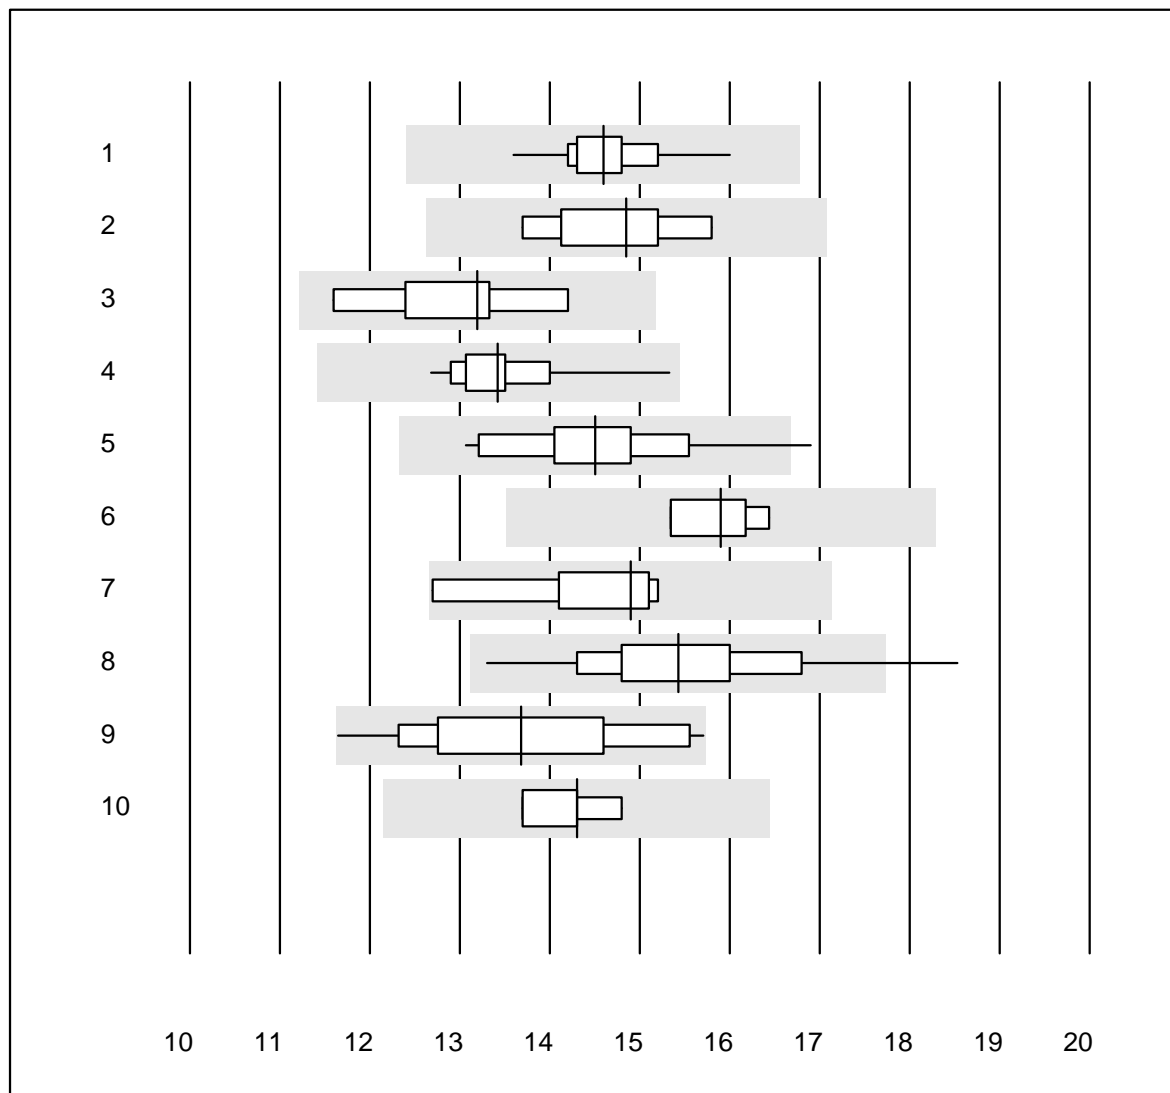


QUALAB Tolérance : 15 %

pO2 (kPa)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	ABL700/800	98	99.0	0.0	1.0	14.59	3.1	e
2	ABL80 FLEX	6	100.0	0.0	0.0	14.85	5.1	e*
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	9	88.9	0.0	11.1	13.20	6.4	e*
4	ABL90 FLEX / PLUS	87	96.6	0.0	3.4	13.42	4.1	e
5	Cobas b 123	17	94.1	5.9	0.0	14.51	6.4	e
6	Cobas b 221	4	100.0	0.0	0.0	15.90	3.1	e
7	GEM	7	100.0	0.0	0.0	14.90	6.2	e*
8	iStat	39	94.8	2.6	2.6	15.43	6.5	e
9	EPOC	49	95.9	0.0	4.1	13.68	7.9	e
10	IL	4	100.0	0.0	0.0	14.30	3.2	e

pH

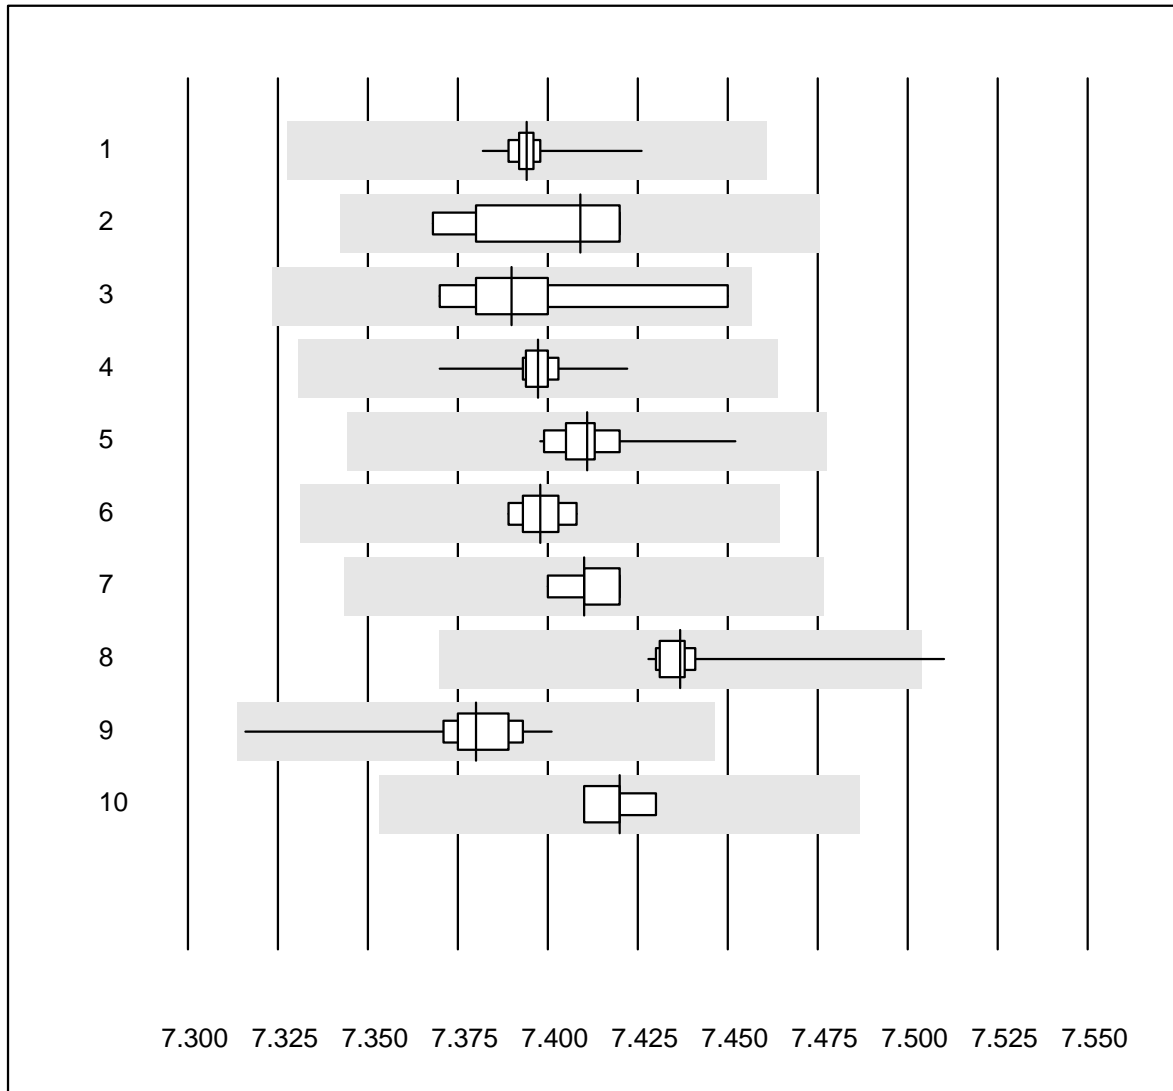


QUALAB Tolérance : 1 %

pH ()

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	ABL700/800	98	100.0	0.0	0.0	7.39	0.1	e
2	ABL80 FLEX	7	100.0	0.0	0.0	7.41	0.3	e
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	9	100.0	0.0	0.0	7.39	0.3	e
4	ABL90 FLEX / PLUS	87	98.9	0.0	1.1	7.40	0.1	e
5	Cobas b 123	15	100.0	0.0	0.0	7.41	0.2	e
6	Cobas b 221	7	100.0	0.0	0.0	7.40	0.1	e
7	GEM	7	100.0	0.0	0.0	7.41	0.1	e
8	iStat	43	95.4	2.3	2.3	7.44	0.2	e
9	EPOC	50	100.0	0.0	0.0	7.38	0.2	e
10	IL	4	100.0	0.0	0.0	7.42	0.1	e

Glucose GS

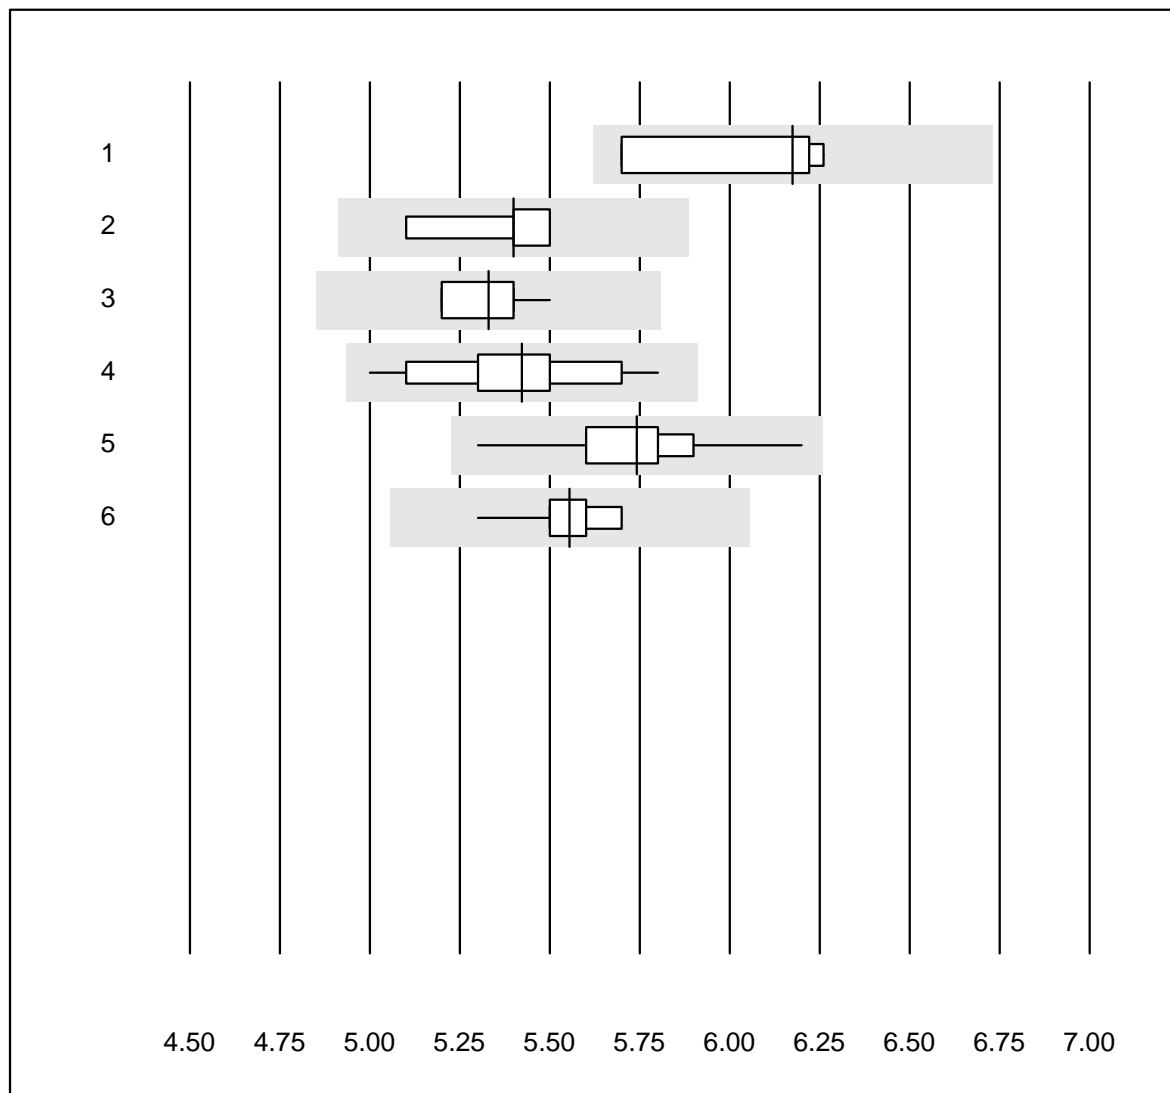


QUALAB Tolérance : 9 %

Glucose GS (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas b 221	4	100.0	0.0	0.0	6.2	4.2	e*
2 Cobas b 123	9	100.0	0.0	0.0	5.4	2.4	e
3 iStat	10	100.0	0.0	0.0	5.3	2.0	e
4 EPOC	38	94.7	0.0	5.3	5.4	3.6	e
5 ABL700/800	90	100.0	0.0	0.0	5.7	2.6	e
6 ABL90 FLEX / PLUS	81	98.8	0.0	1.2	5.6	1.7	e

Hémoglobine BG

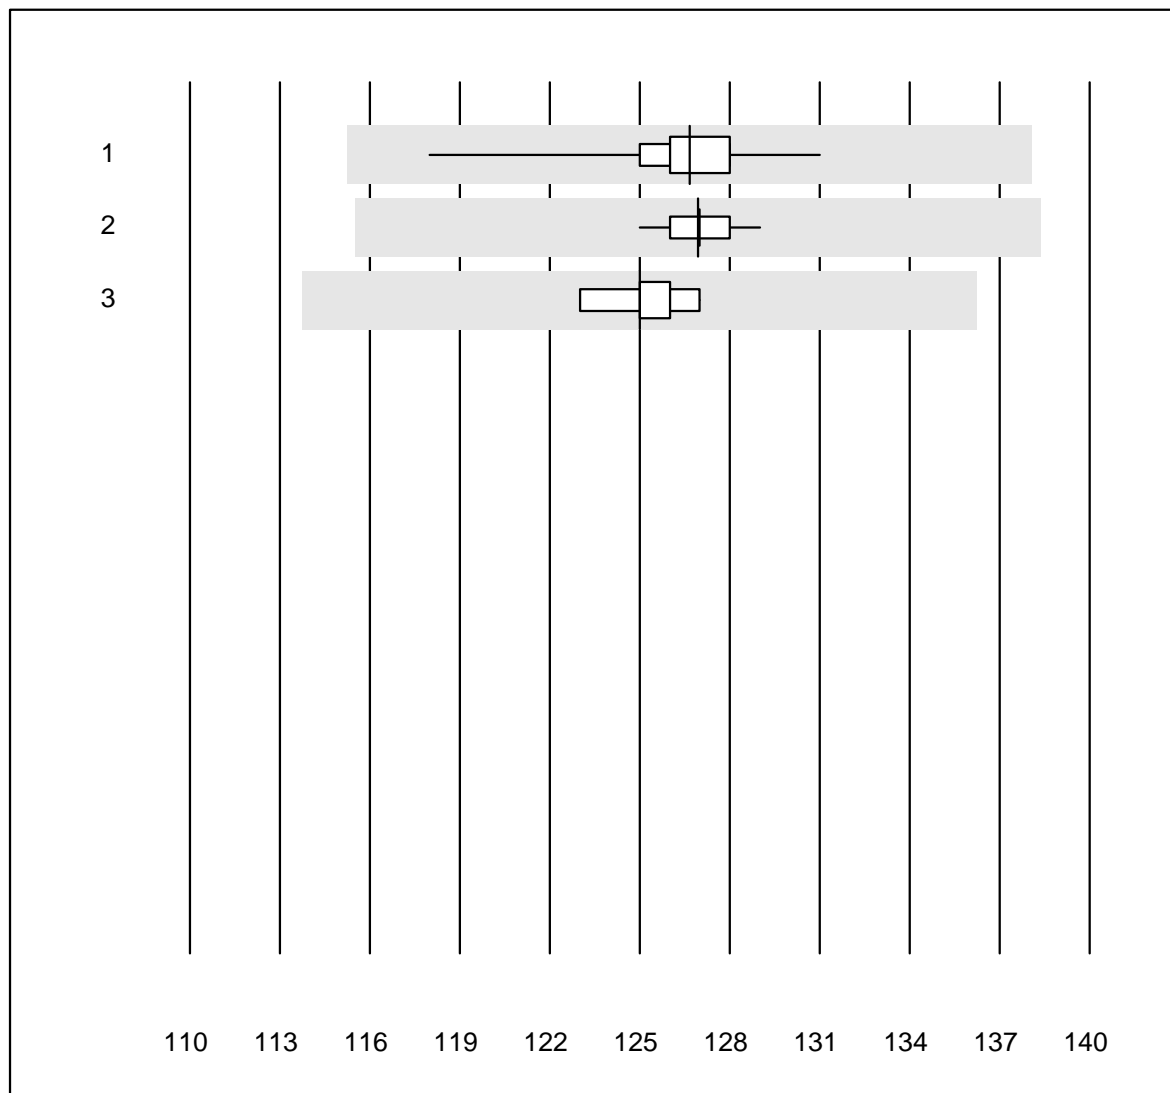


QUALAB Tolérance : 9 %

Hémoglobine BG (g/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 ABL700/800	91	92.3	0.0	7.7	126.7	1.7	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	81	97.5	0.0	2.5	126.9	0.5	e
3 ABL80 FLEX CO-OX / O	6	83.3	0.0	16.7	125.0	1.2	e

Potassium BG

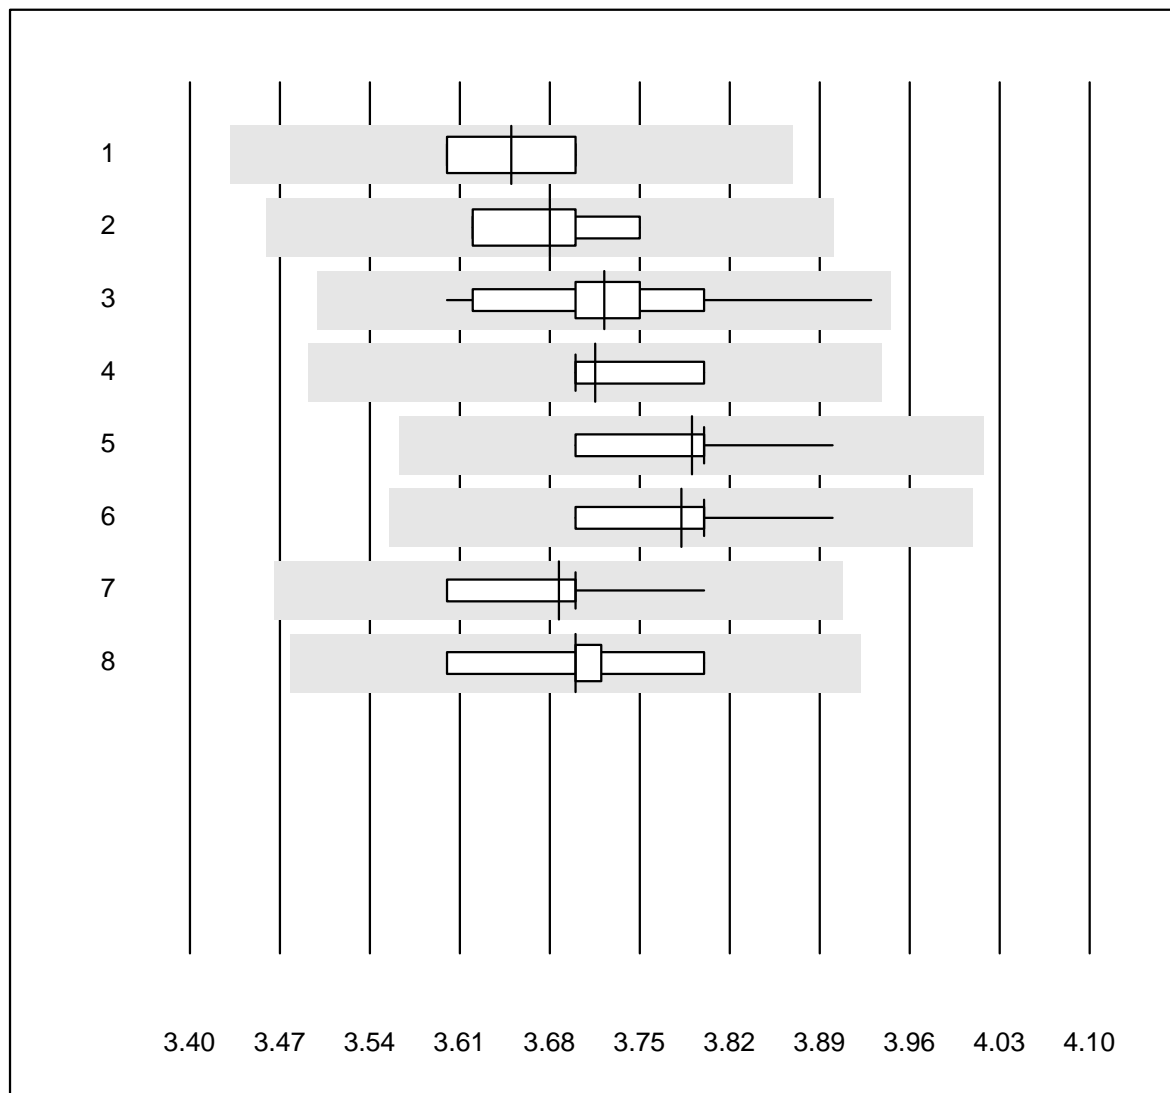


QUALAB Tolérance : 6 %

Potassium BG (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 GEM	4	100.0	0.0	0.0	3.7	1.6	e*
2 ABL80 FLEX	4	100.0	0.0	0.0	3.7	1.5	e*
3 Cobas b 123	19	100.0	0.0	0.0	3.7	1.9	e
4 iStat	20	100.0	0.0	0.0	3.7	1.0	e
5 EPOC	43	97.7	0.0	2.3	3.8	1.1	e
6 ABL700/800	91	100.0	0.0	0.0	3.8	1.1	e
7 ABL90 FLEX / PLUS	84	100.0	0.0	0.0	3.7	1.2	e
8 ABL80 FLEX CO-OX / O	5	100.0	0.0	0.0	3.7	1.9	e*

Sodium BG

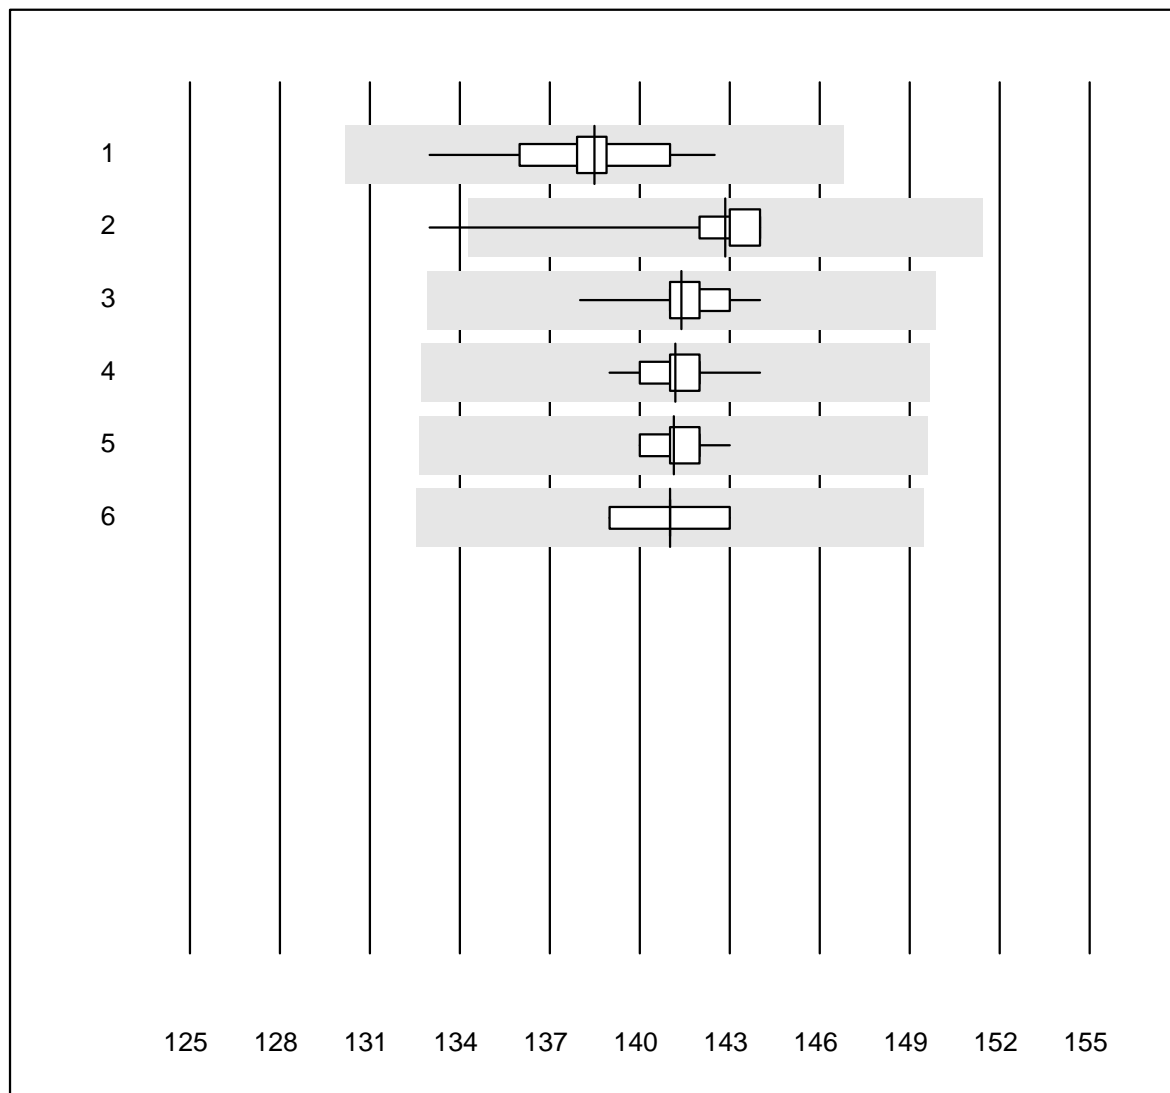


QUALAB Tolérance : 6 %

Sodium BG (mmol/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas b 123	19	100.0	0.0	0.0	138.5	1.4	e
2 iStat	20	95.0	5.0	0.0	142.9	1.7	e
3 EPOC	41	97.6	0.0	2.4	141.4	0.7	e
4 ABL700/800	89	100.0	0.0	0.0	141.2	0.6	e
5 ABL90 FLEX / PLUS	82	100.0	0.0	0.0	141.1	0.5	e
6 ABL80 FLEX CO-OX / O	5	100.0	0.0	0.0	141.0	1.0	e

Chlorure-BG

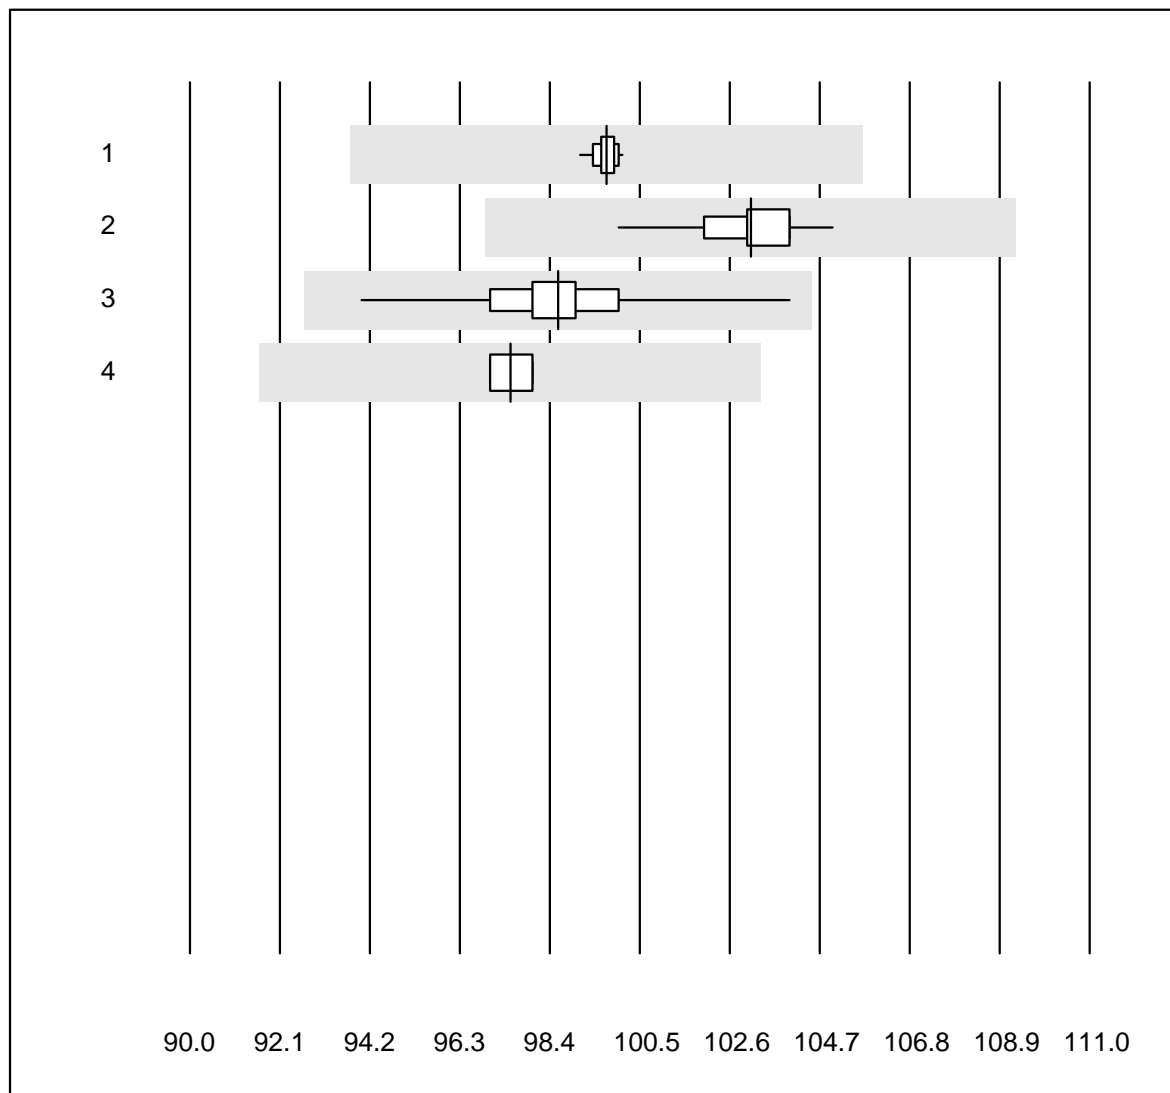


QUALAB Tolérance : 6 %

Chlorure-BG (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas b 123	11	100.0	0.0	0.0	99.7	0.3	e
2 EPOC	11	100.0	0.0	0.0	103.1	1.3	e
3 ABL700/800	82	100.0	0.0	0.0	98.6	1.4	e
4 ABL90 FLEX / PLUS	78	100.0	0.0	0.0	97.5	0.5	e

Calcium-BG

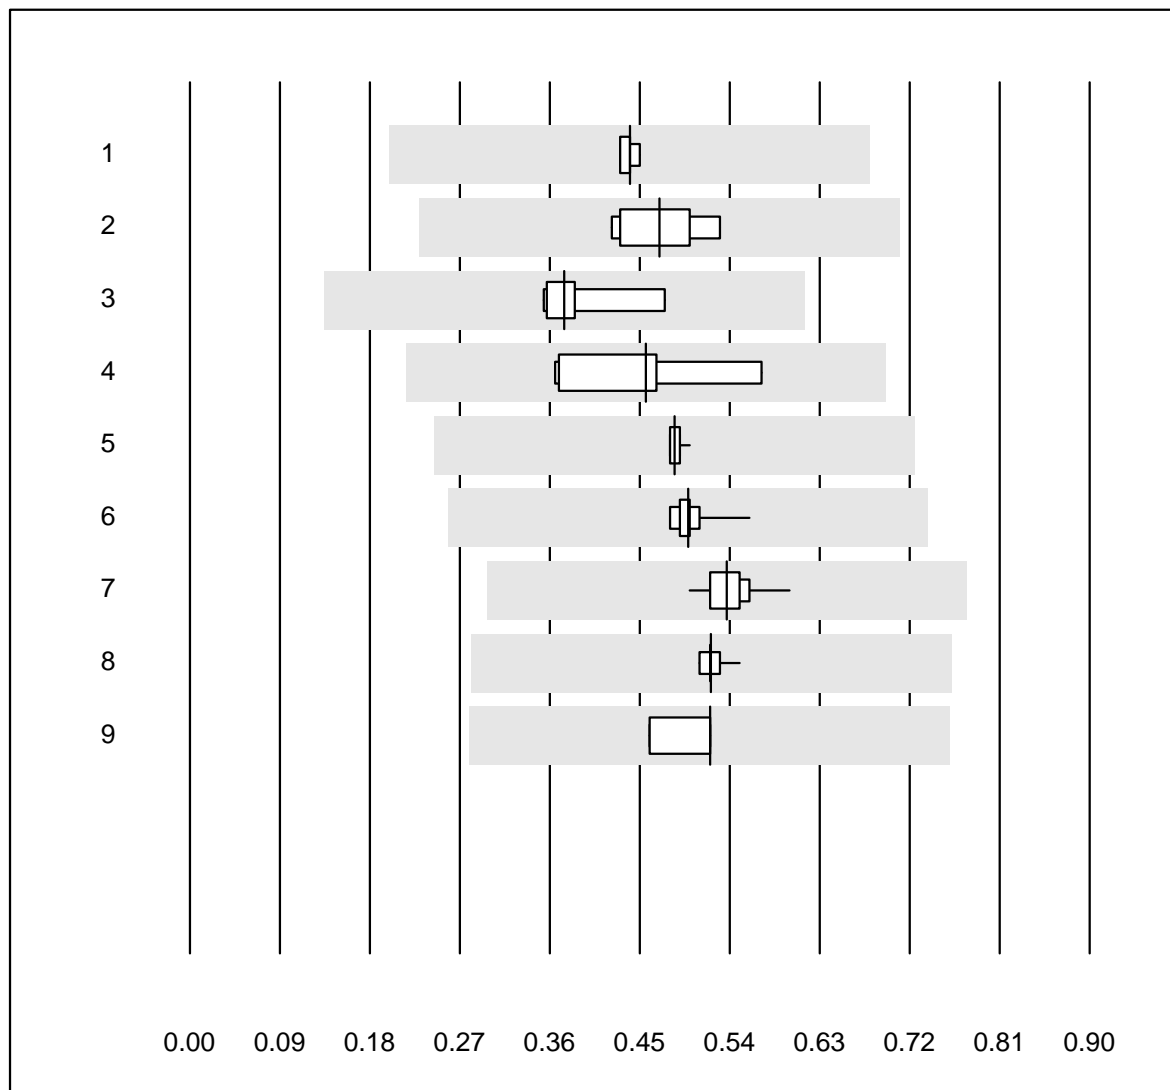


Tolérance MQ : 12 %
(< 2.00: +/- 0.24 mmol/l)

Calcium-BG (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	GEM	5	100.0	0.0	0.0	0.44	1.9	e
2	ABL80 FLEX	5	100.0	0.0	0.0	0.47	9.7	e*
3	Cobas b123	8	100.0	0.0	0.0	0.37	10.4	e*
4	Cobas	8	100.0	0.0	0.0	0.46	16.2	e*
5	iStat	13	100.0	0.0	0.0	0.48	1.4	e
6	EPOC	39	97.4	0.0	2.6	0.50	3.0	e
7	ABL700/800	91	100.0	0.0	0.0	0.54	3.4	e
8	ABL90 FLEX / PLUS	82	100.0	0.0	0.0	0.52	1.4	e
9	ABL80 FLEX CO-OX / O	4	100.0	0.0	0.0	0.52	5.9	e*

Lactate-BG

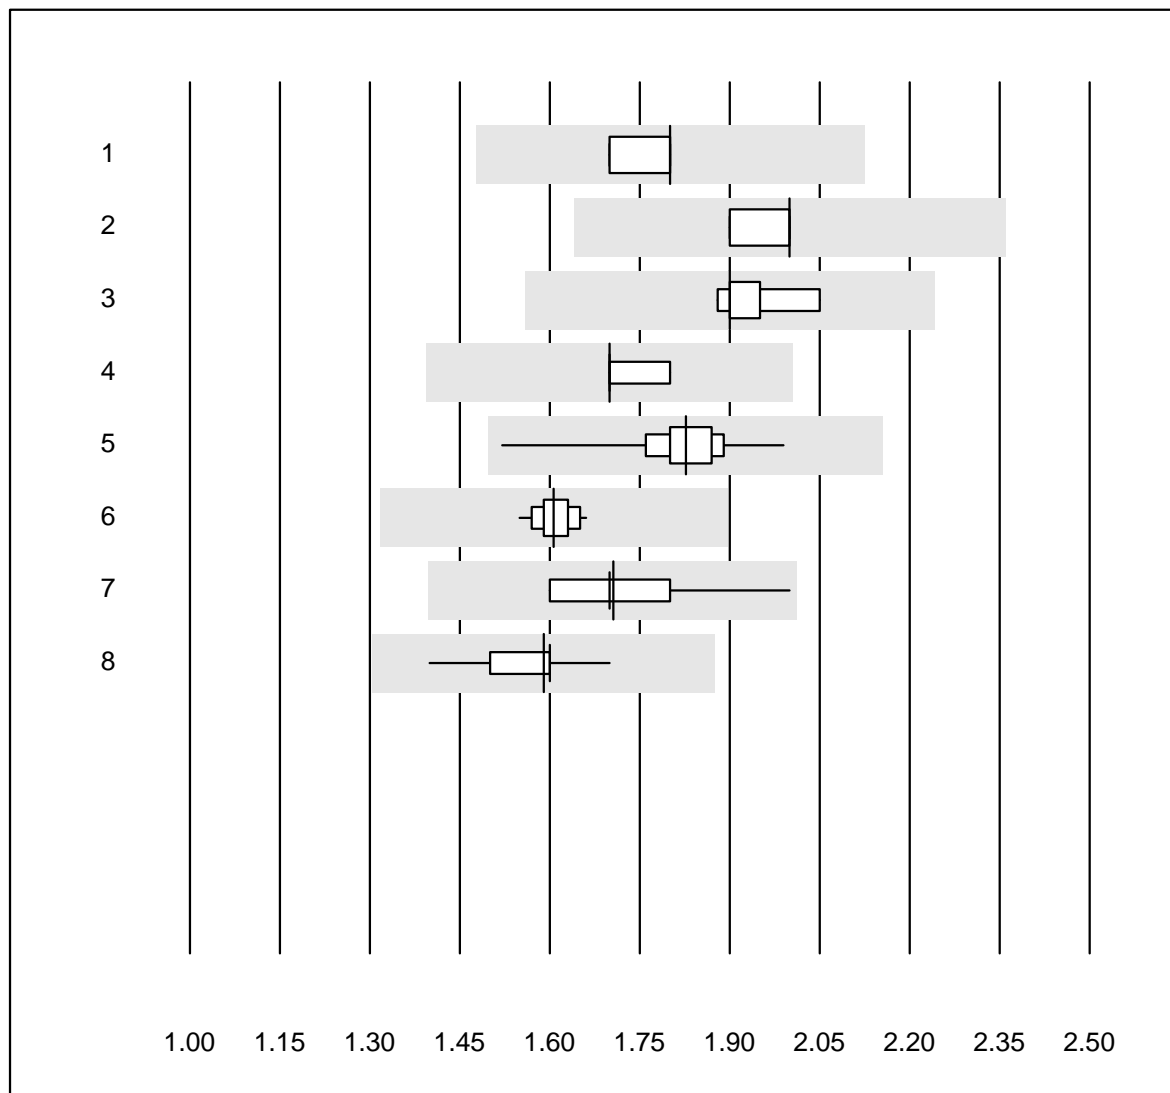


QUALAB Tolérance : 18 %

Lactate-BG (mmol/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 GEM	4	100.0	0.0	0.0	1.80	2.8	e
2 Cobas b123	7	100.0	0.0	0.0	2.00	2.7	e
3 Cobas	6	100.0	0.0	0.0	1.90	3.3	e
4 IL	4	100.0	0.0	0.0	1.70	2.9	e
5 EPOC	38	100.0	0.0	0.0	1.83	4.2	e
6 iStat	13	100.0	0.0	0.0	1.61	2.0	e
7 ABL700/800	93	100.0	0.0	0.0	1.71	4.1	e
8 ABL90 FLEX / PLUS	84	100.0	0.0	0.0	1.59	3.1	e

sO2 OR

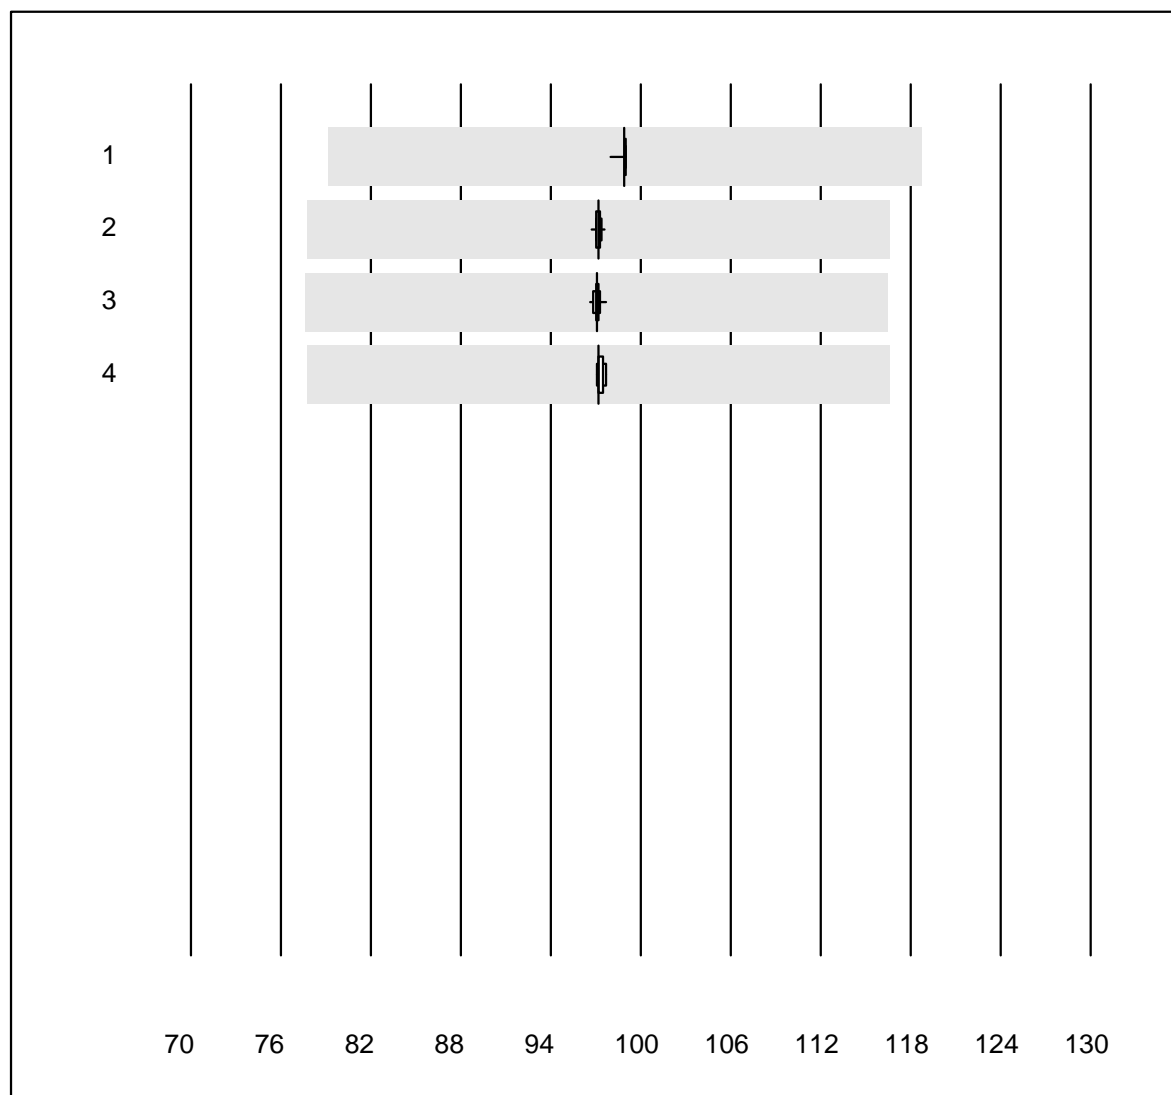


Tolérance MQ : 20 %

sO2 OR (%)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 iStat	11	100.0	0.0	0.0	98.909	0.3	e
2 ABL700/800	81	100.0	0.0	0.0	97.158	0.2	e
3 ABL90 FLEX / PLUS	76	100.0	0.0	0.0	97.087	0.2	e
4 ABL80 FLEX CO-OX / O	5	100.0	0.0	0.0	97.200	0.3	e

FO2Hb OR

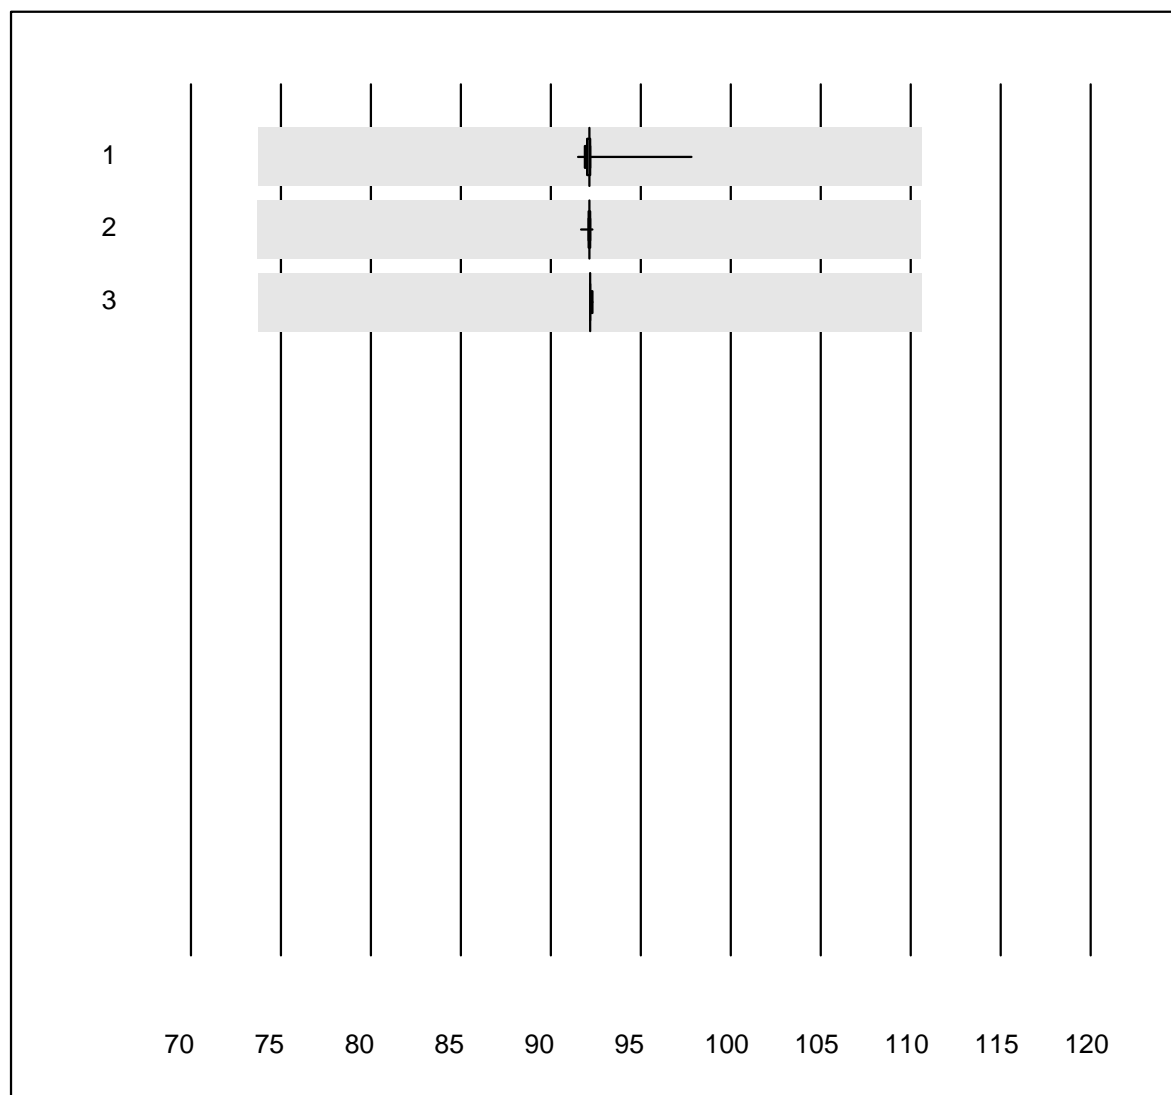


Tolérance MQ : 20 %

FO2Hb OR (%)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 ABL700/800	80	100.0	0.0	0.0	92.156	0.7	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	75	100.0	0.0	0.0	92.147	0.1	e
3 ABL80 FLEX CO-OX / O	6	100.0	0.0	0.0	92.200	0.0	e

FCOHb OR

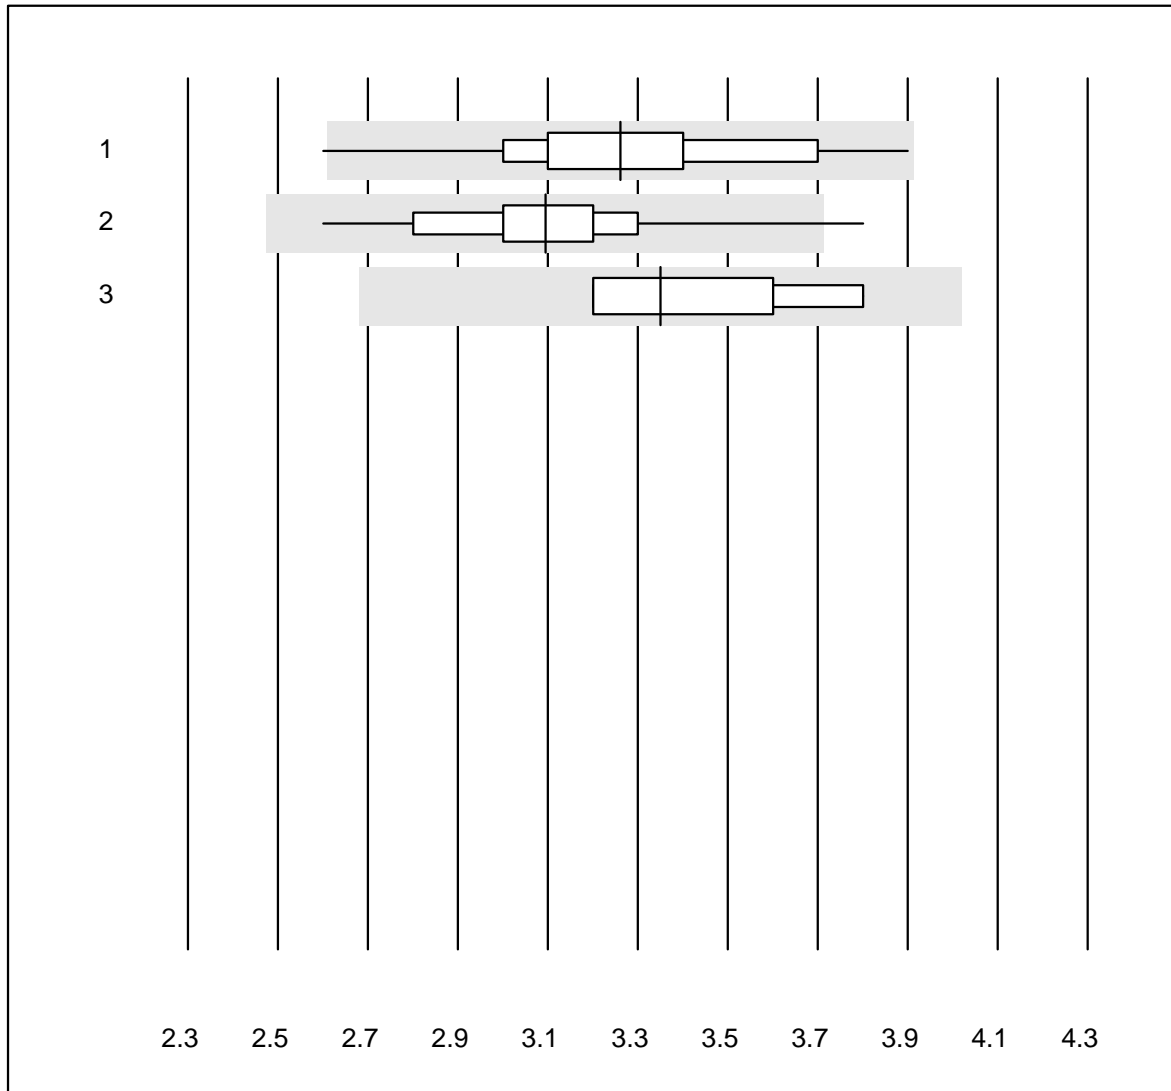


Tolérance MQ : 20 %

FCOHb OR (%)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 ABL700/800	82	97.6	2.4	0.0	3.261	8.5	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	73	98.6	1.4	0.0	3.095	7.3	e
3 ABL80 FLEX CO-OX / O	6	100.0	0.0	0.0	3.350	7.0	e*

FMetHb OR

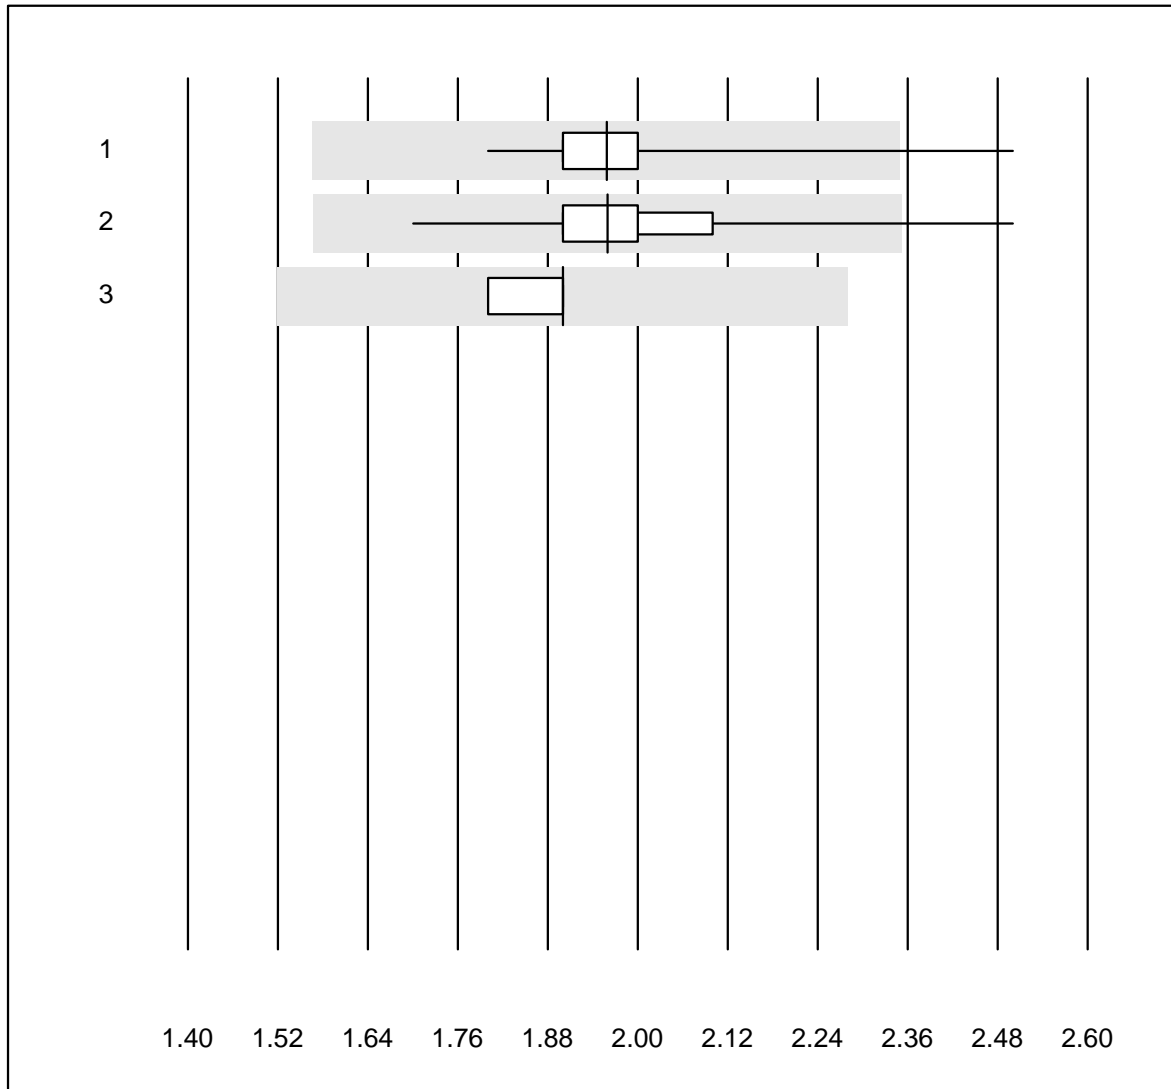


Tolérance MQ : 20 %

FMetHb OR (%)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 ABL700/800	82	98.8	1.2	0.0	1.959	5.6	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	74	98.6	1.4	0.0	1.960	5.5	e
3 ABL80 FLEX CO-OX / O	6	100.0	0.0	0.0	1.900	2.8	e

FHbF OR

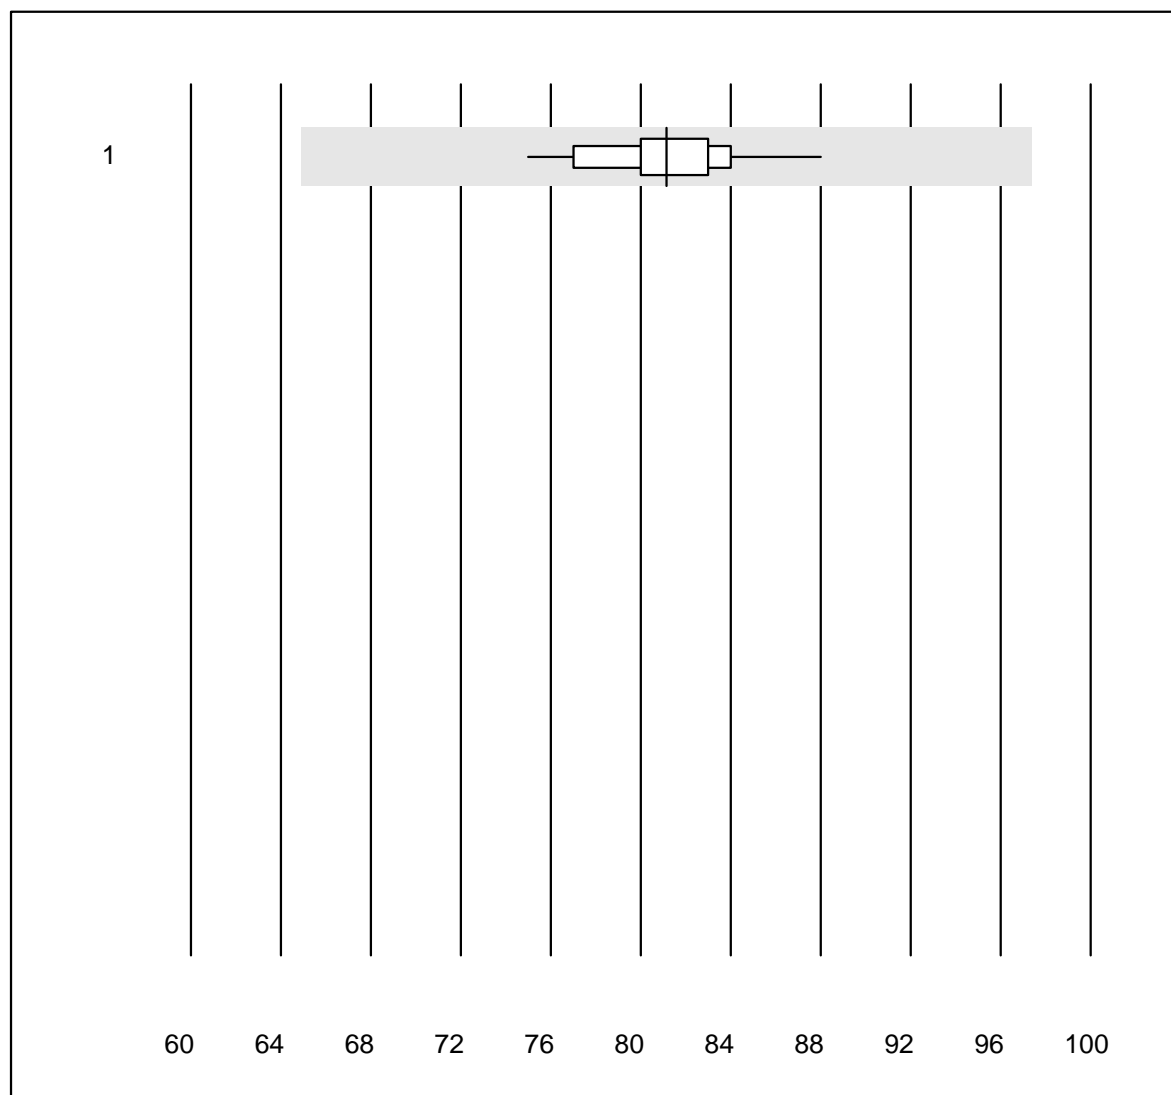


Tolérance MQ : 20 %

FHbF OR (%)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 ABL90 FLEX / PLUS	28	96.4	0.0	3.6	81.148	3.5	e

Bilirubin OR

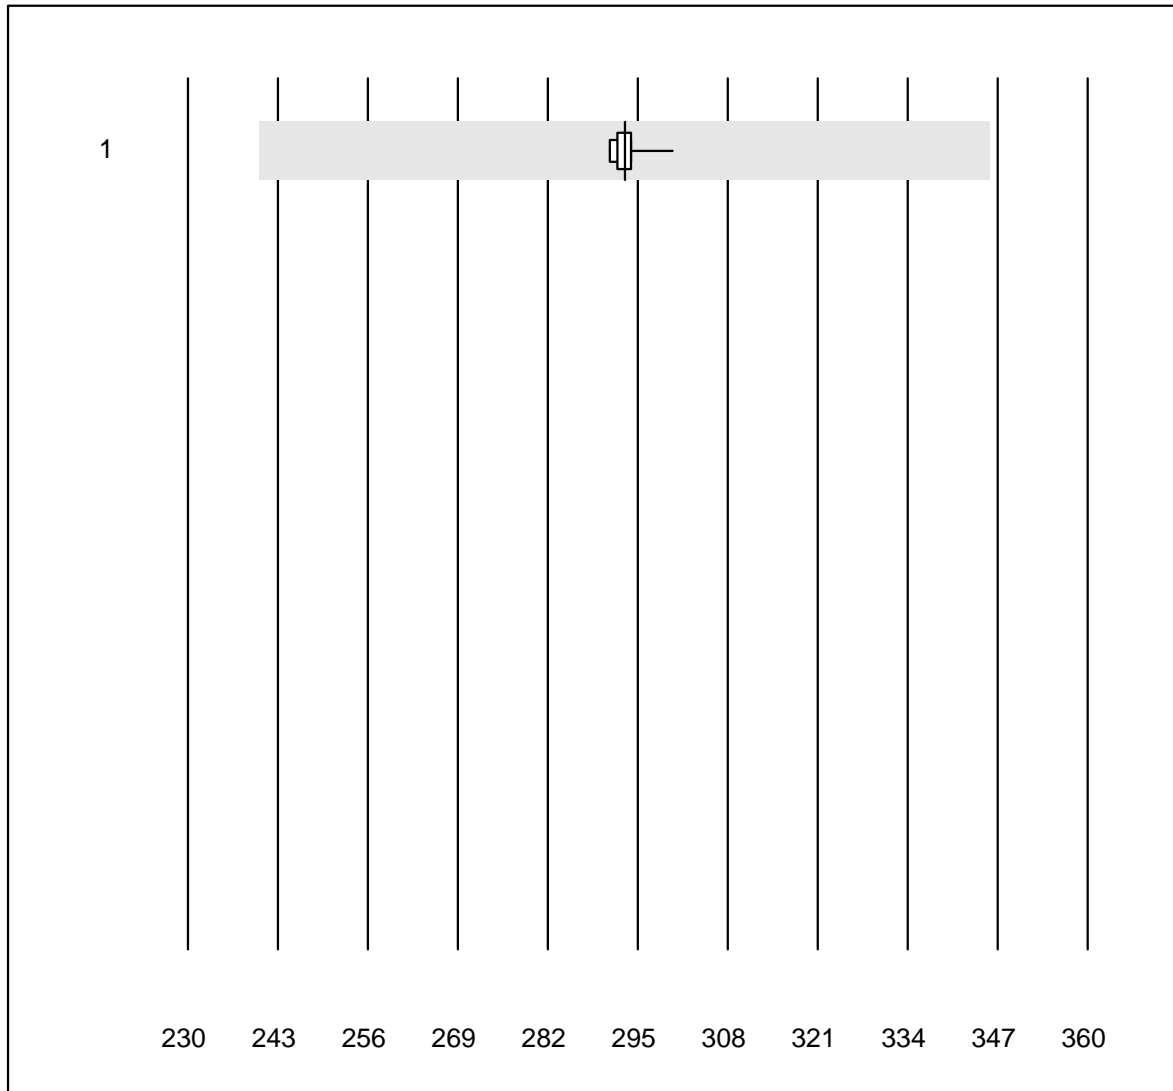


QUALAB Tolérance : 18 %

Bilirubin OR (µmol/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 ABL90 FLEX / PLUS	30	100.0	0.0	0.0	293.2	0.7	e

Troponine I

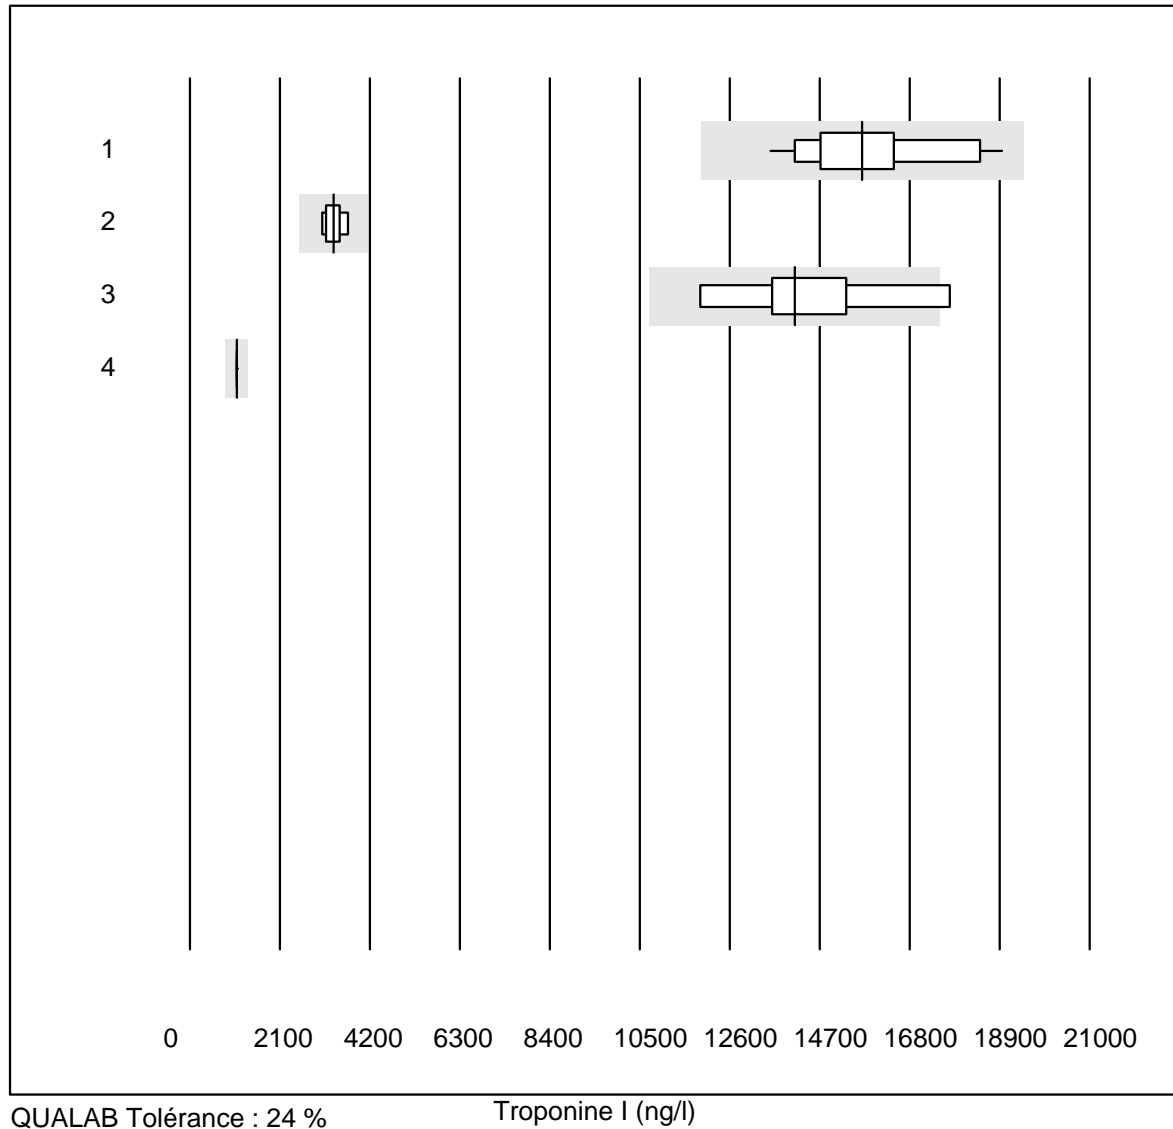

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Vidas	12	100.0	0.0	0.0	15691.9	10.4	e*
2 Architect High Sensi	9	100.0	0.0	0.0	3348.0	6.7	e
3 Autres méthodes	7	85.7	14.3	0.0	14117.0	12.4	e*
4 AQT 90 FLEX	5	100.0	0.0	0.0	1100.0	0.0	e

Troponine T

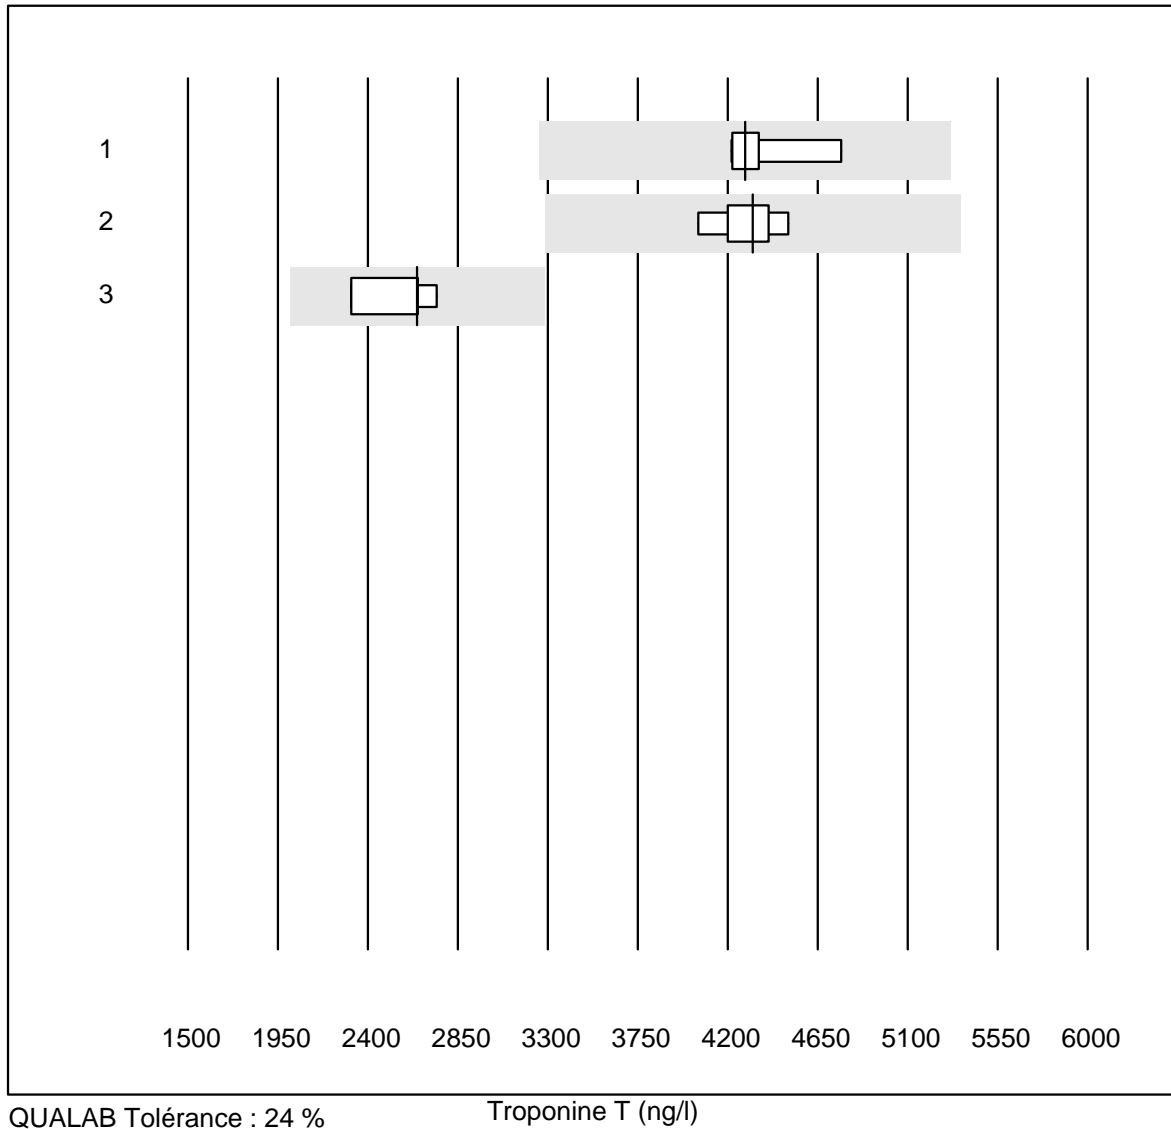


QUALAB Tolérance : 24 %

Troponine T (ng/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas hs	6	100.0	0.0	0.0	4286.00	4.8	e
2 Cobas hs STAT	8	100.0	0.0	0.0	4326.50	3.3	e
3 Cobas E / Elecsys	4	100.0	0.0	0.0	2646.00	7.2	e*

Myoglobine

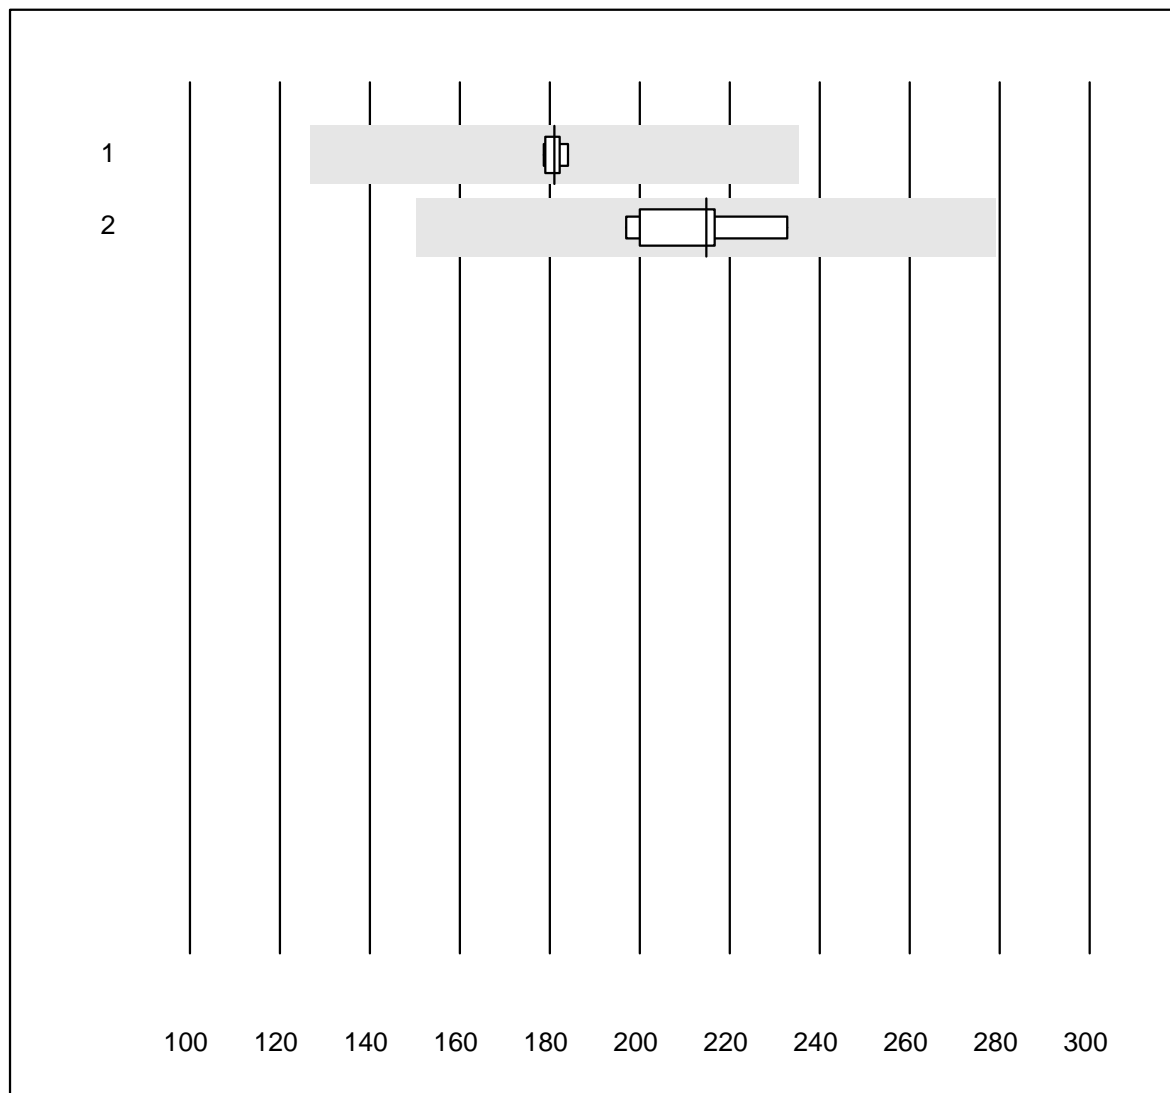


QUALAB Tolérance : 30 %

Myoglobine (µg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	5	100.0	0.0	0.0	181.0	1.2	e
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	214.8	6.8	e

masse CK-MB

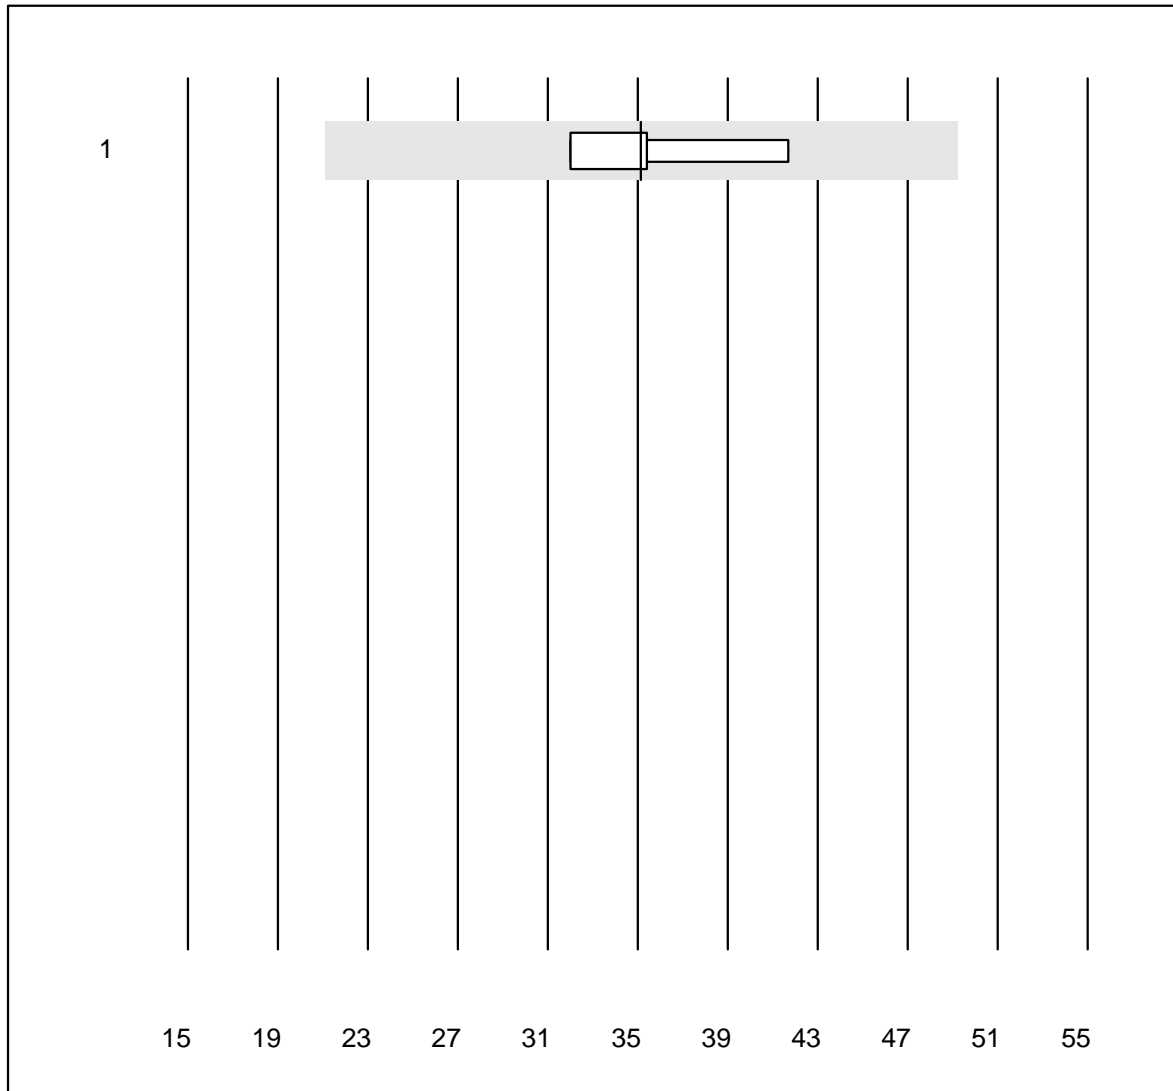


Tolérance MQ : 40 %

masse CK-MB (µg/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	4	100.0	0.0	0.0	35.2	11.3	e*

BNP

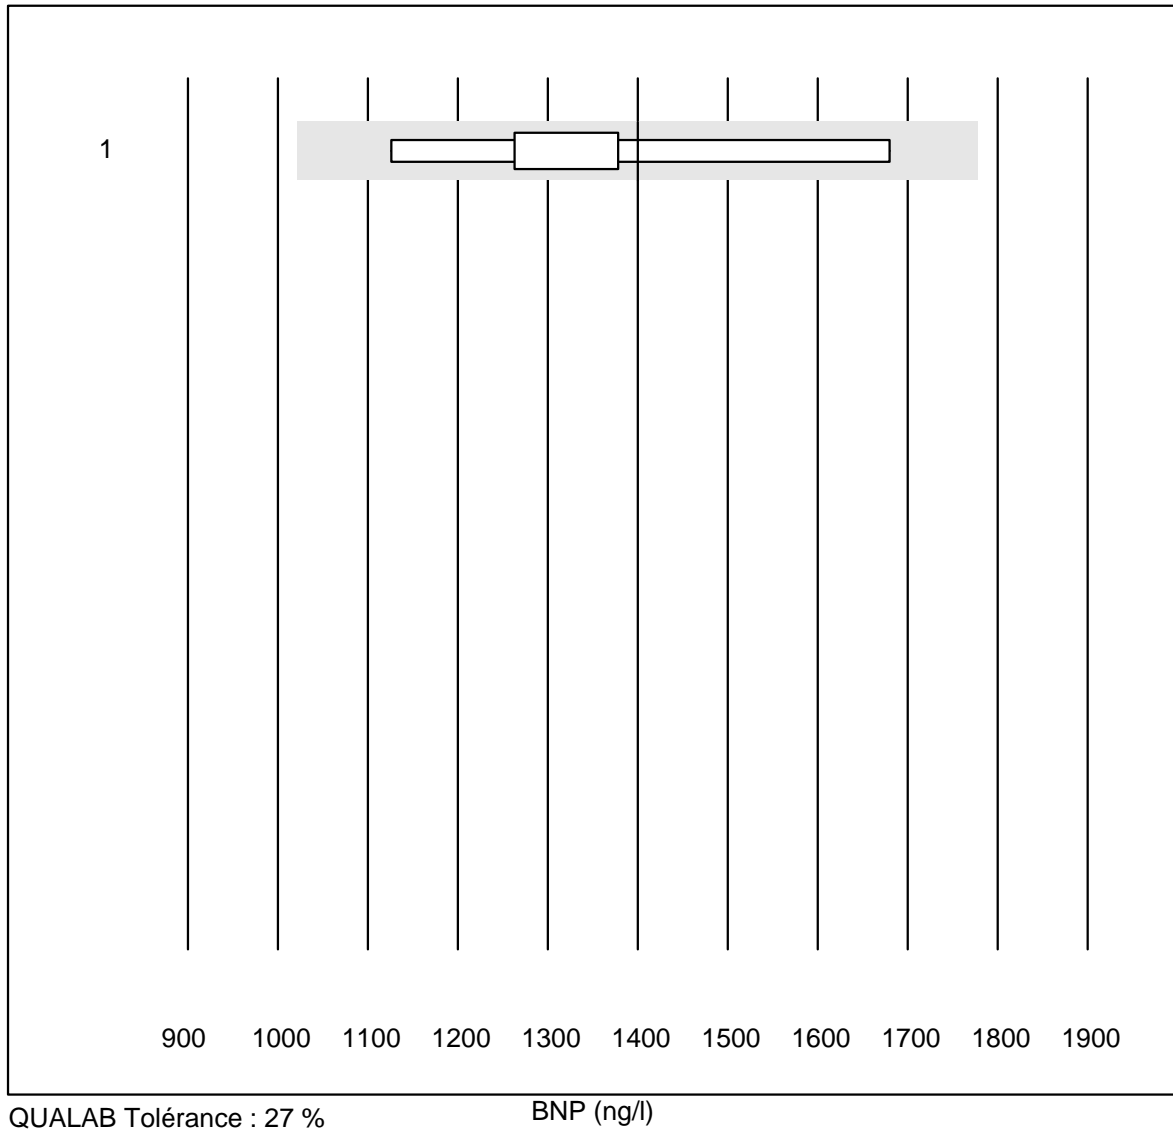


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Autres méthodes	6	100.0	0.0	0.0	1400.0	13.8	a

NT-proBNP

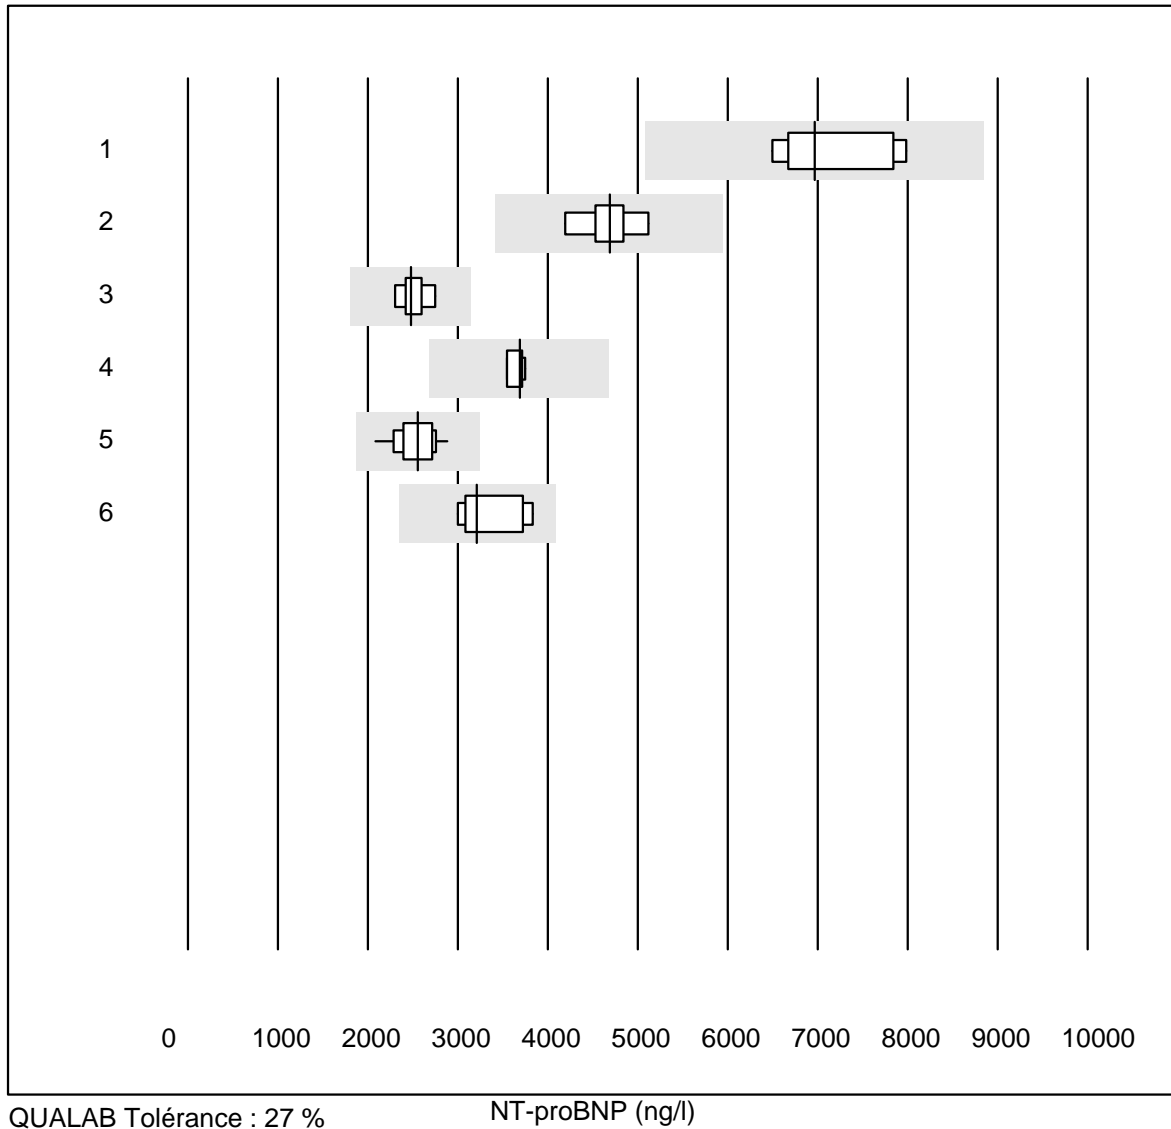


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Pathfast	6	100.0	0.0	0.0	6969.0	8.7	e*
2 AQT 90 FLEX	6	100.0	0.0	0.0	4685.0	6.7	e
3 VIDAS	9	100.0	0.0	0.0	2476.0	6.4	e
4 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	3685.0	2.4	e
5 Cobas E / Elecsys	15	100.0	0.0	0.0	2551.5	8.3	e
6 Architect	7	100.0	0.0	0.0	3214.0	9.8	e*

TSH

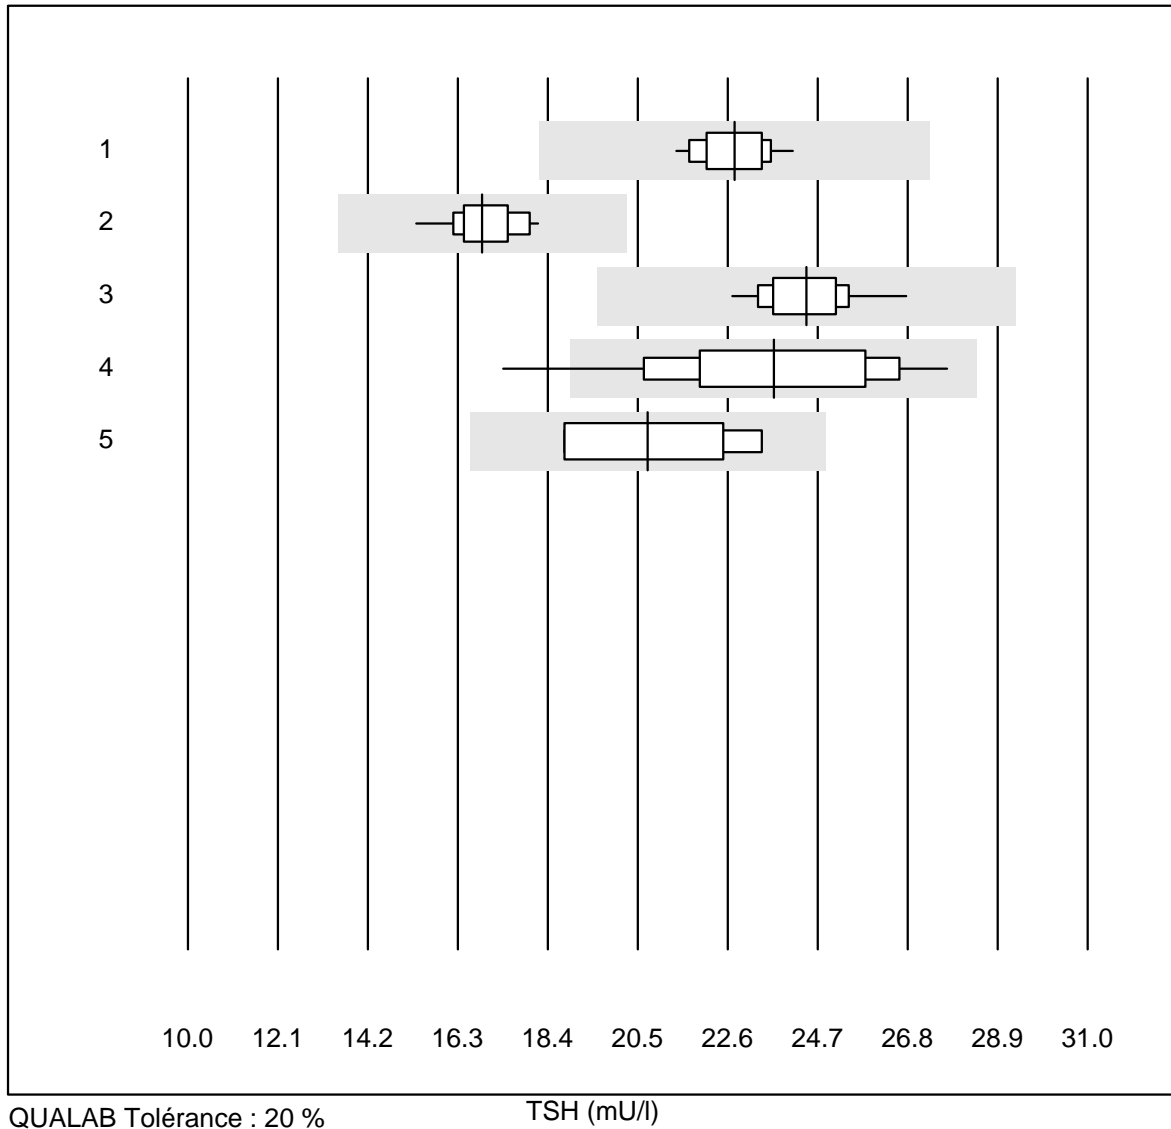

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	17	100.0	0.0	0.0	22.77	3.3	e
2 Architect	11	100.0	0.0	0.0	16.87	4.8	e
3 VIDAS	15	100.0	0.0	0.0	24.44	4.1	e
4 AFIAS	35	94.2	2.9	2.9	23.67	10.1	e
5 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	20.74	11.4	e*


T3

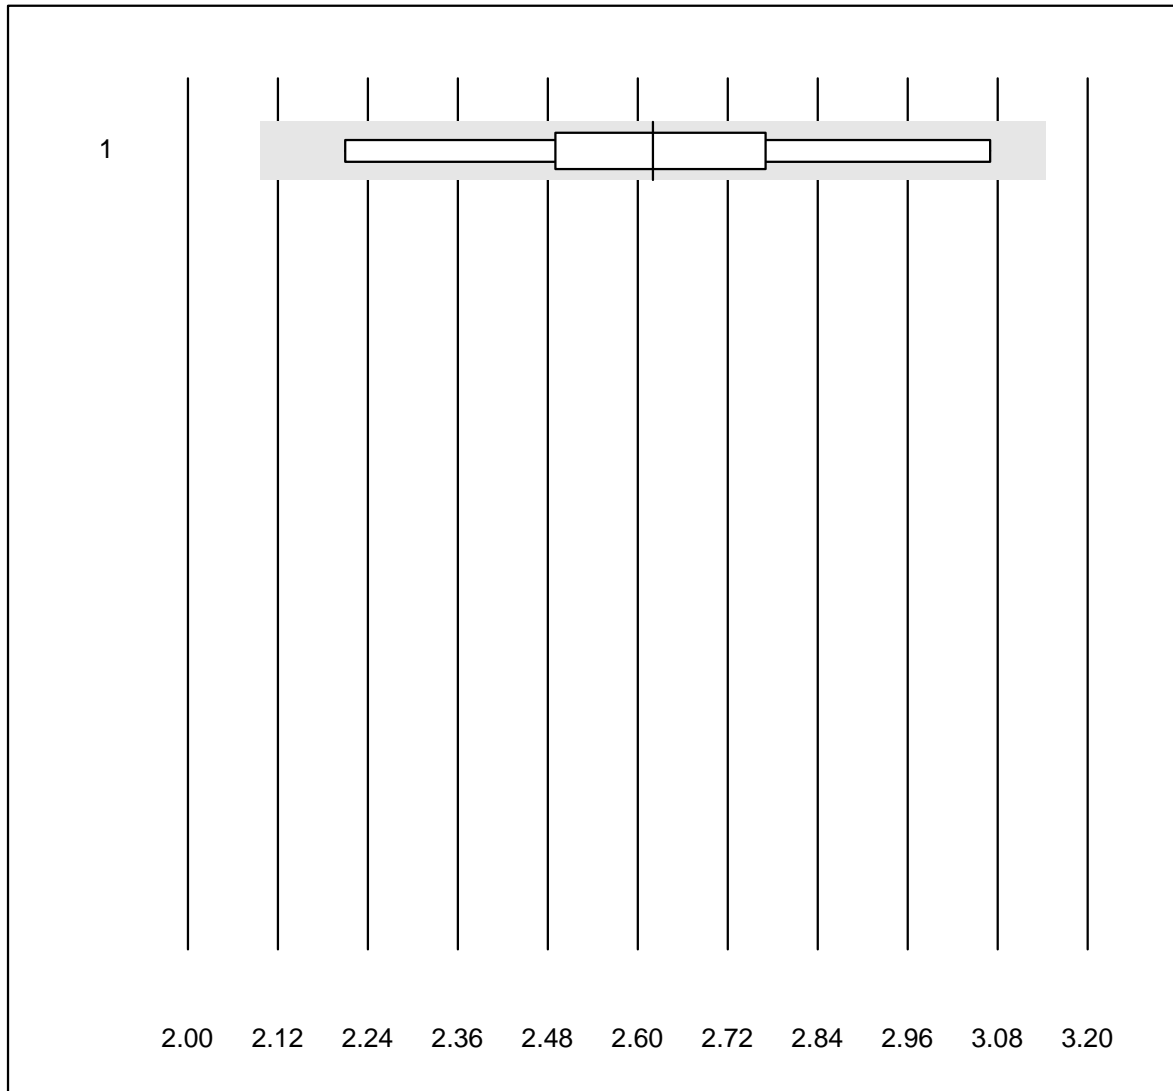

Tolérance MQ : 20 %


T3 (nmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 AFIAS	9	100.0	0.0	0.0	2.6	9.4	e*

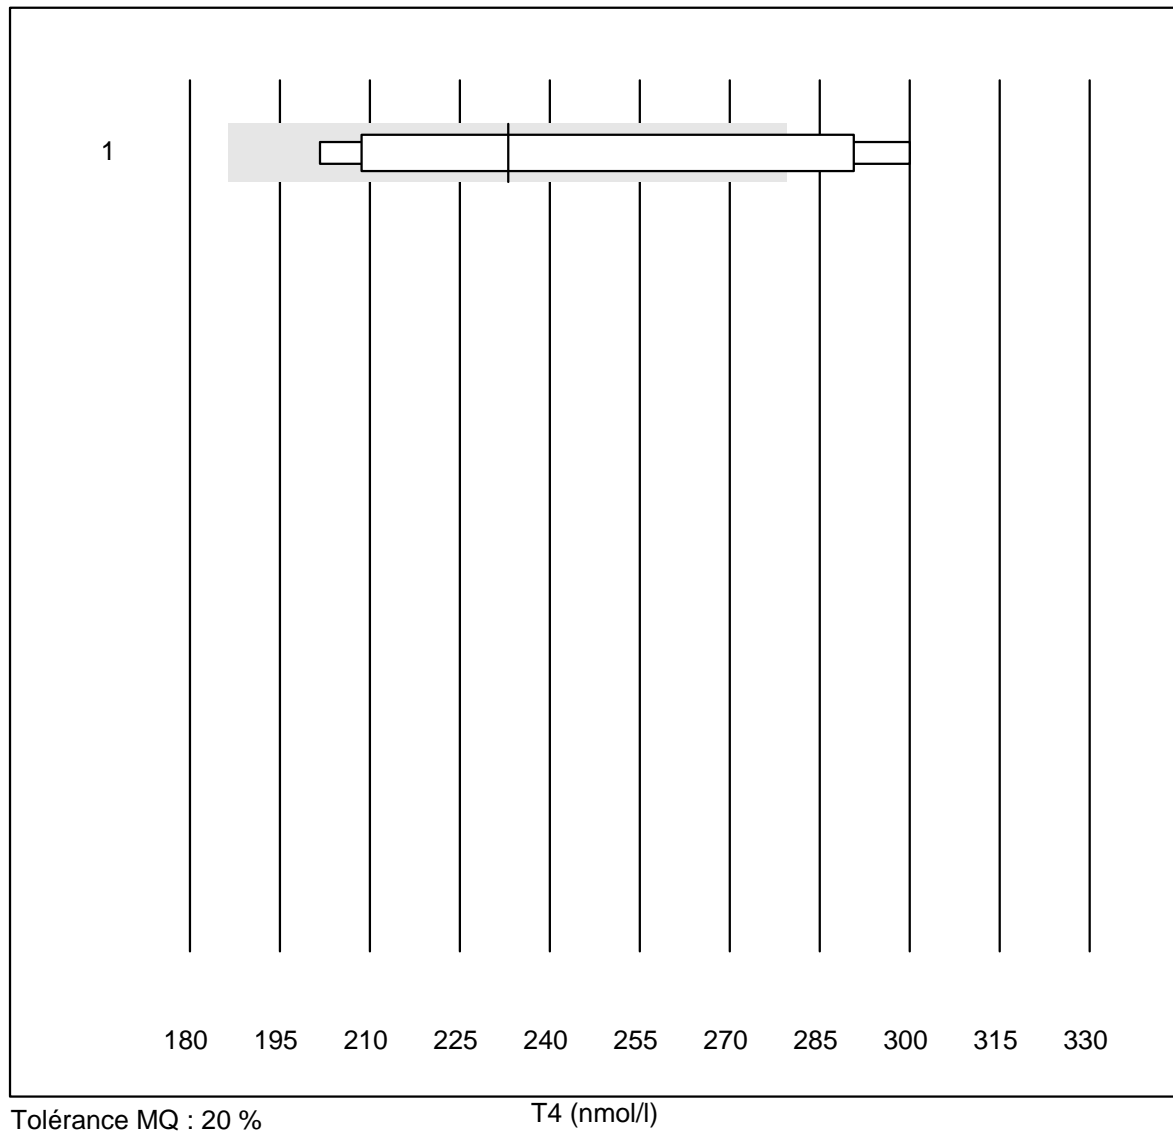T4

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 AFIAS	9	55.6	33.3	11.1	233	15.8	e*

FT3

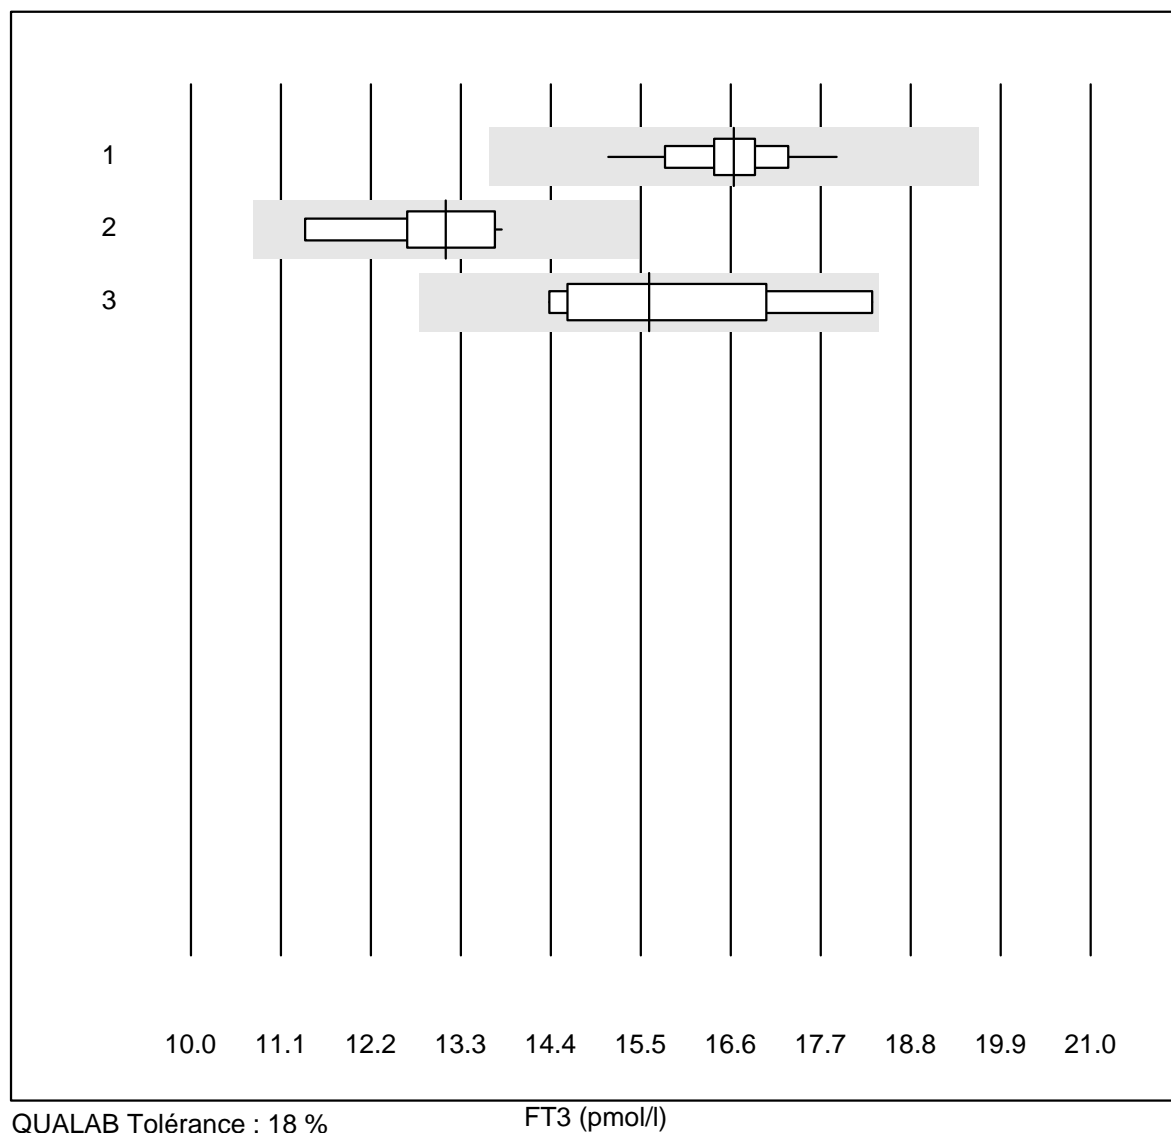


QUALAB Tolérance : 18 %

FT3 (pmol/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	17	100.0	0.0	0.0	16.6	3.7	e
2 Architect	10	100.0	0.0	0.0	13.1	6.0	e
3 VIDAS	7	100.0	0.0	0.0	15.6	8.9	e*

FT4

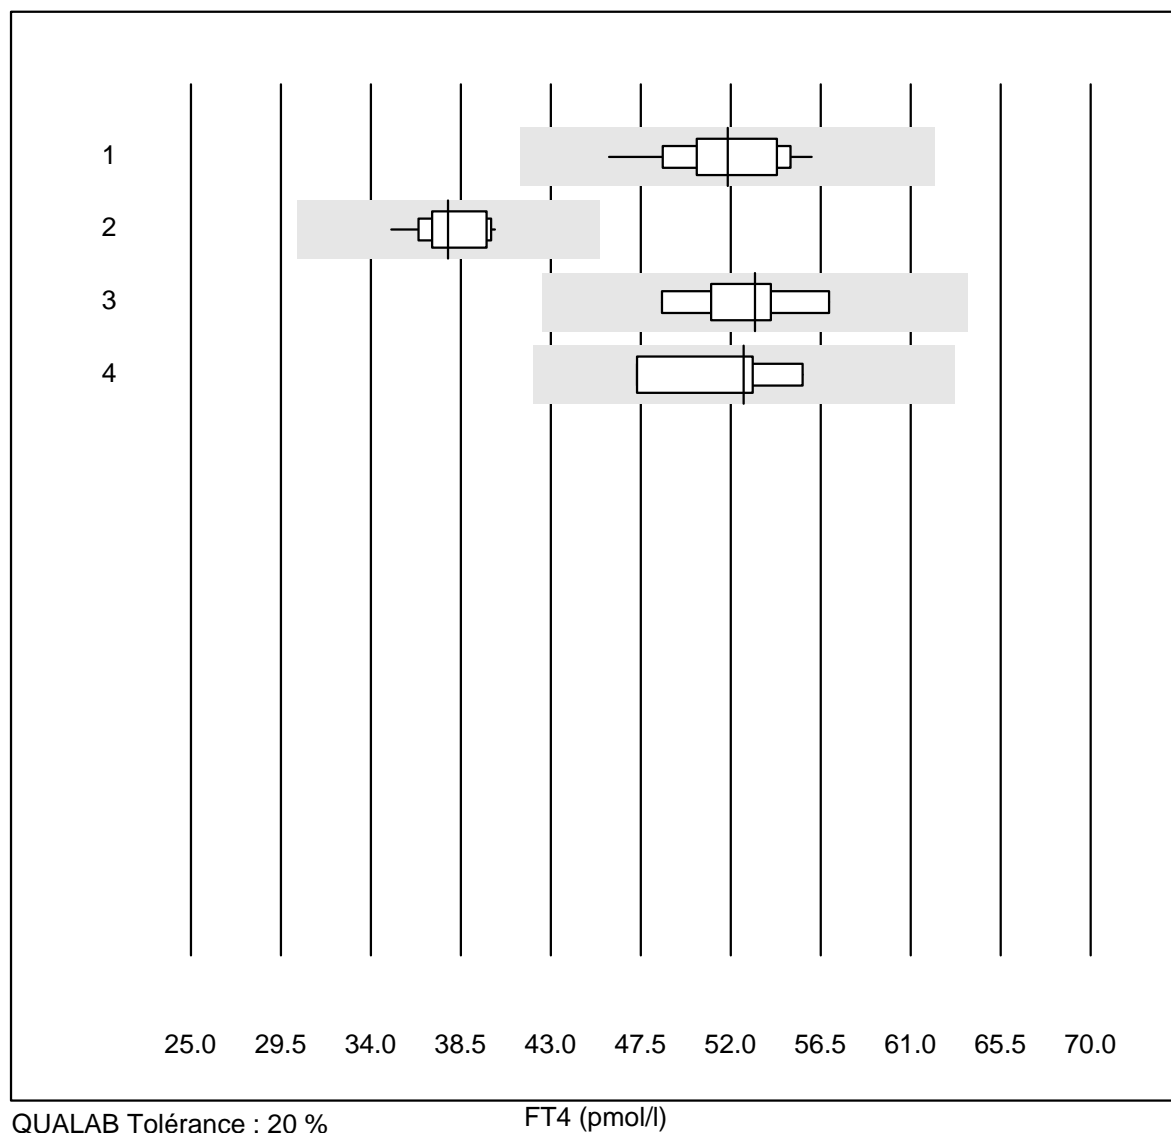

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	17	100.0	0.0	0.0	51.9	5.4	e
2 Architect	11	100.0	0.0	0.0	37.9	4.2	e
3 VIDAS	8	100.0	0.0	0.0	53.2	5.2	e
4 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	52.7	6.7	e*

Testostérone

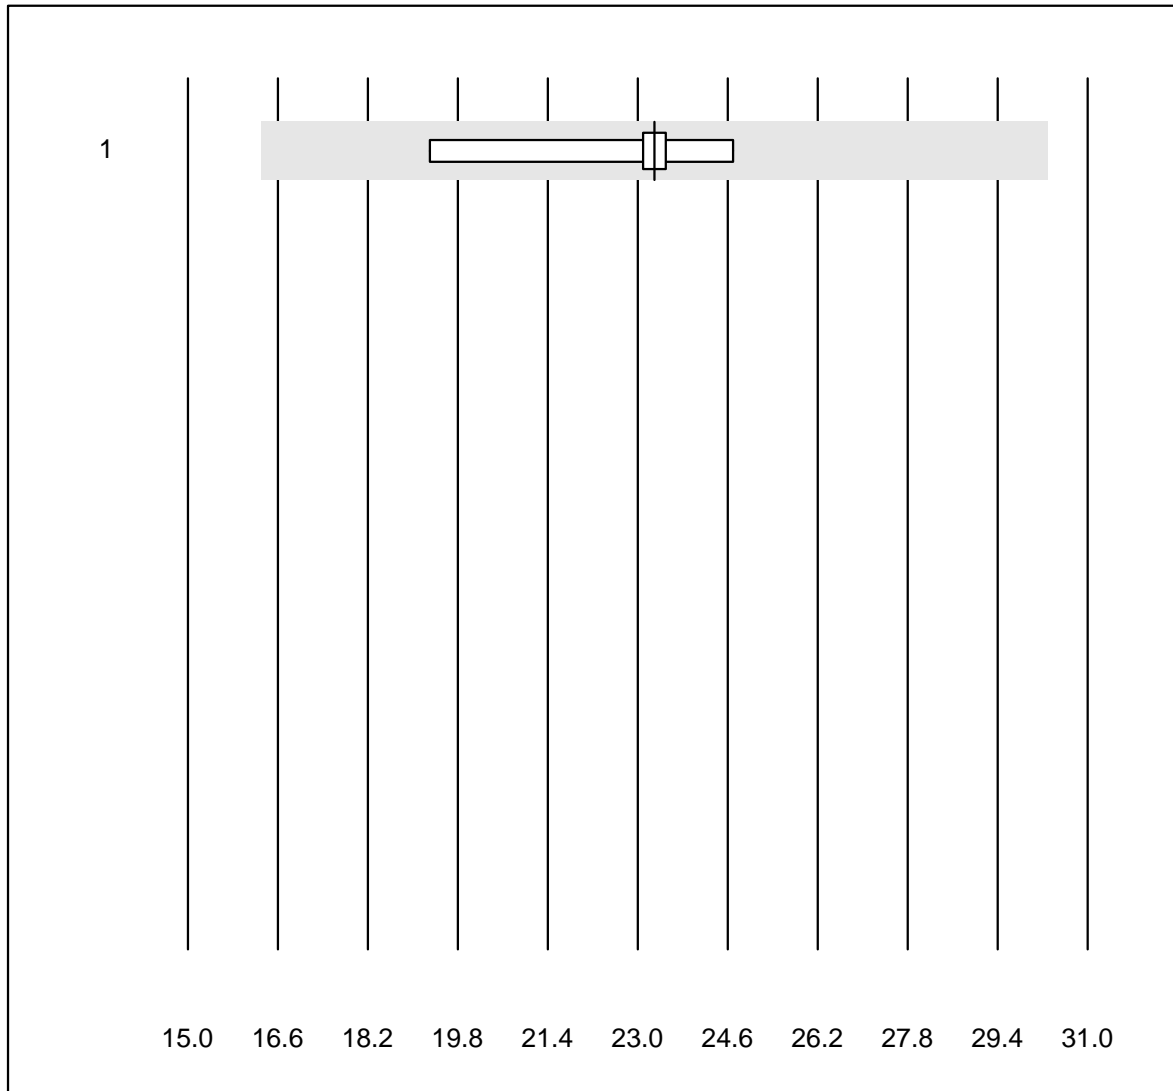


QUALAB Tolérance : 30 %

Testostérone (nmol/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	9	100.0	0.0	0.0	23.3	6.9	e

Estradiol

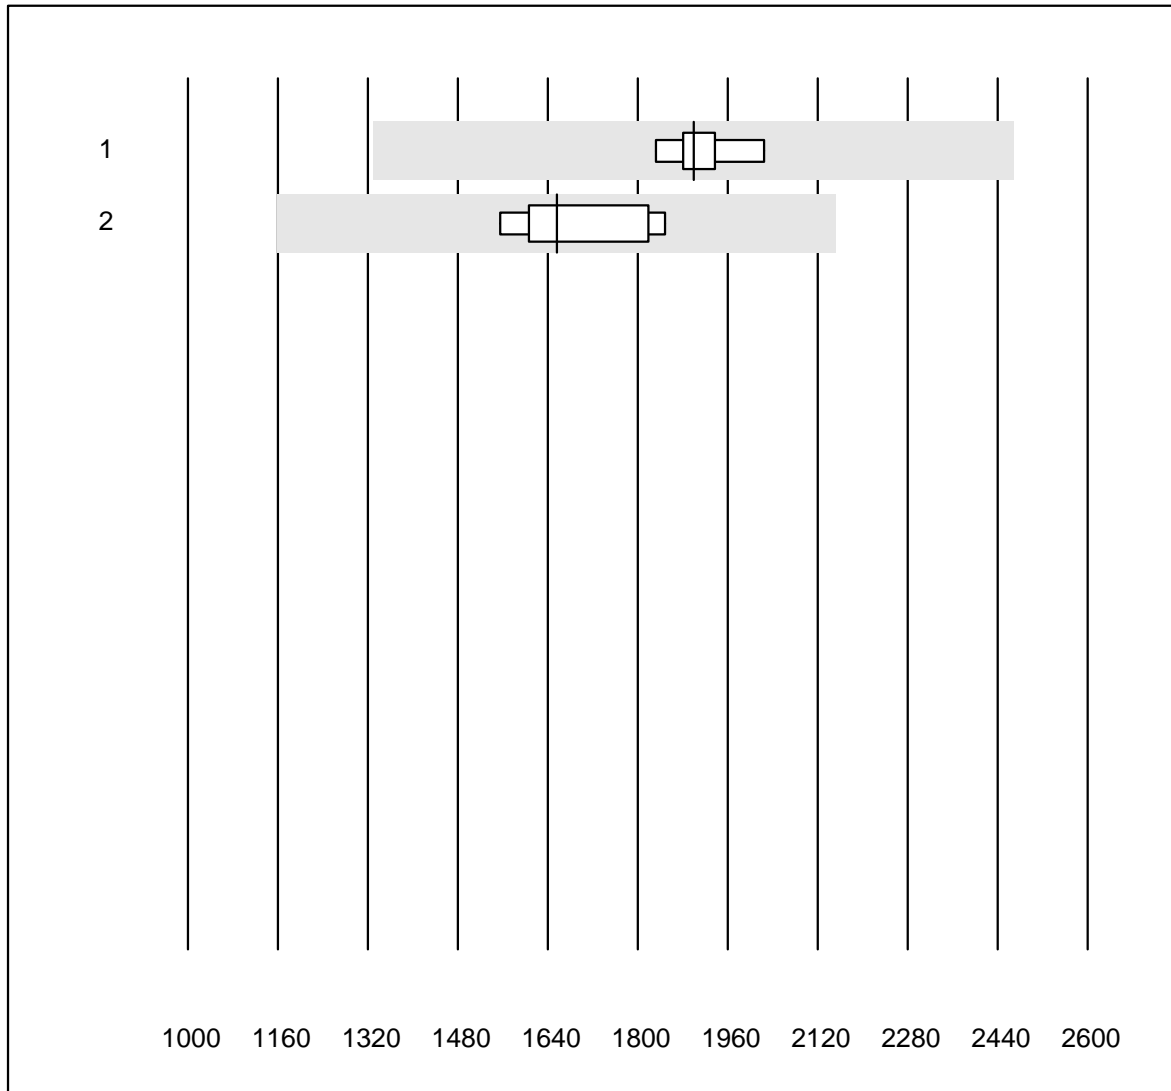


QUALAB Tolérance : 30 %

Estradiol (pmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	7	100.0	0.0	0.0	1899	3.1	e
2 Architect	6	100.0	0.0	0.0	1656	7.0	e

SHBG

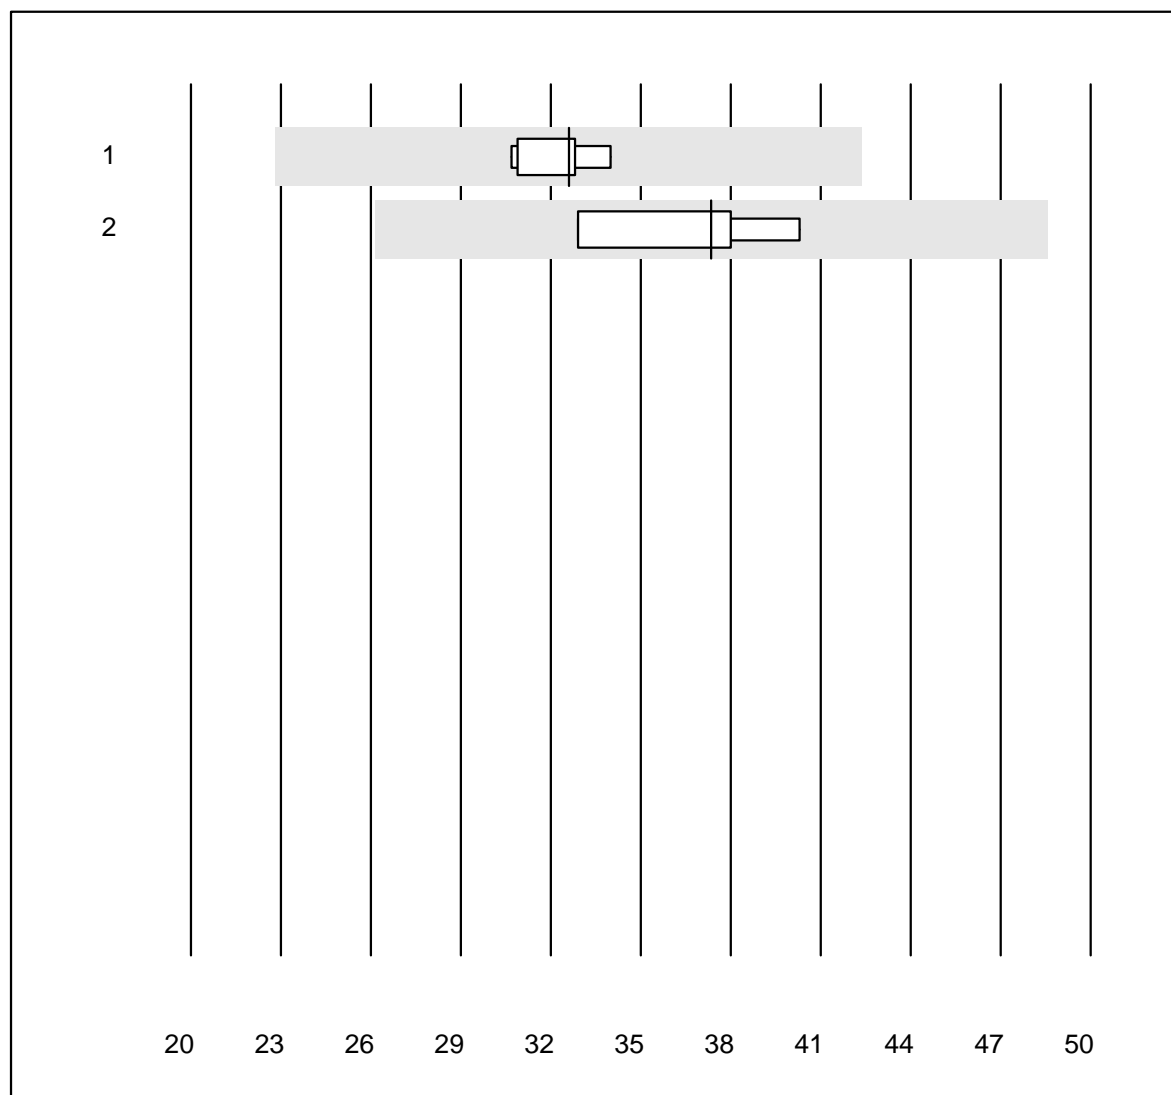


Tolérance MQ : 30 %

SHBG (nmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	7	100.0	0.0	0.0	32.6	3.8	e
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	37.4	8.4	e*

Cortisol

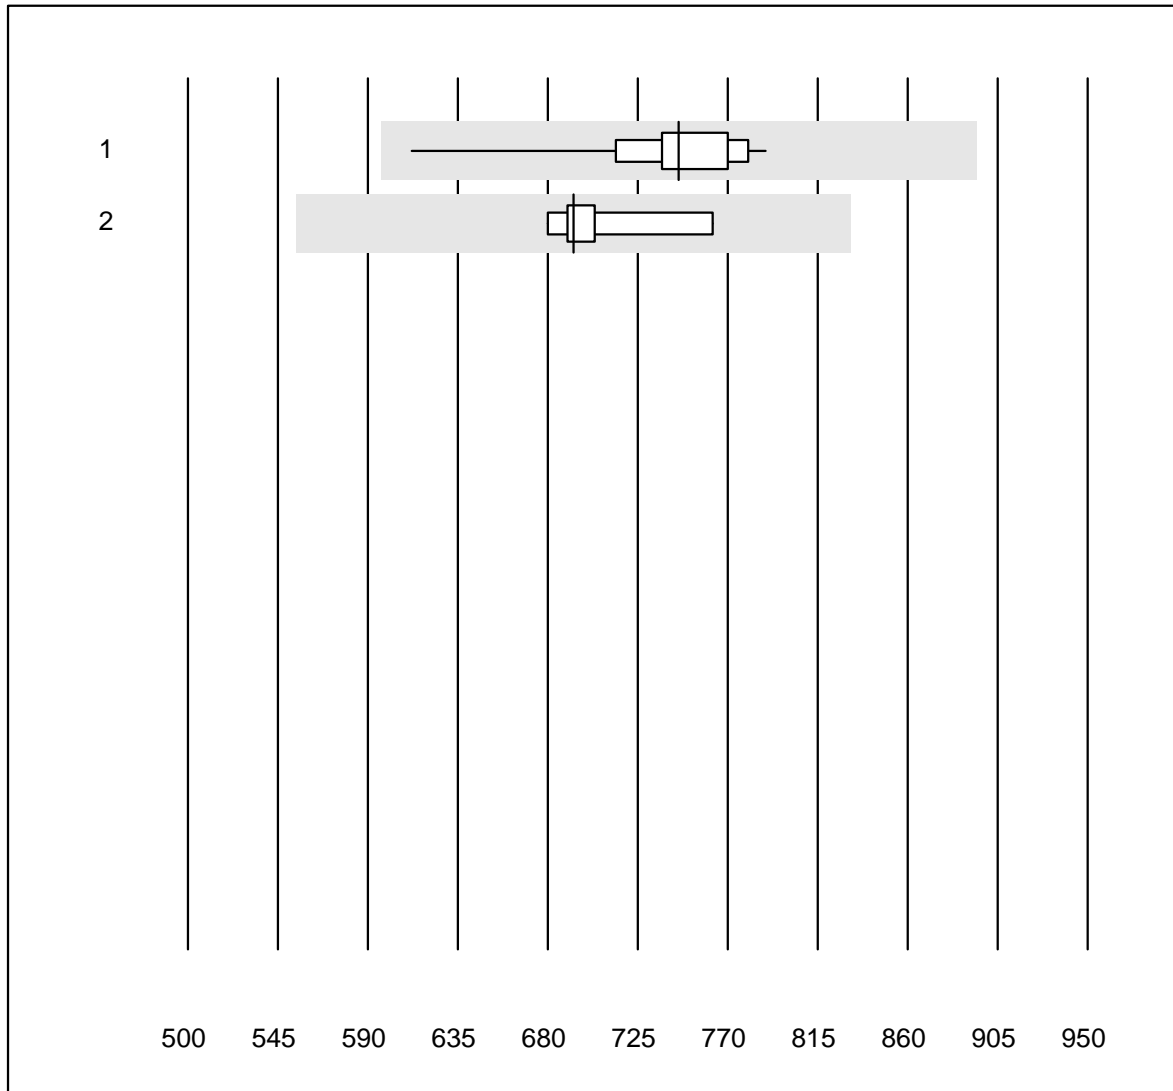


QUALAB Tolérance : 20 %

Cortisol (nmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	13	100.0	0.0	0.0	745	6.1	e
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	693	4.6	e

Progesteron

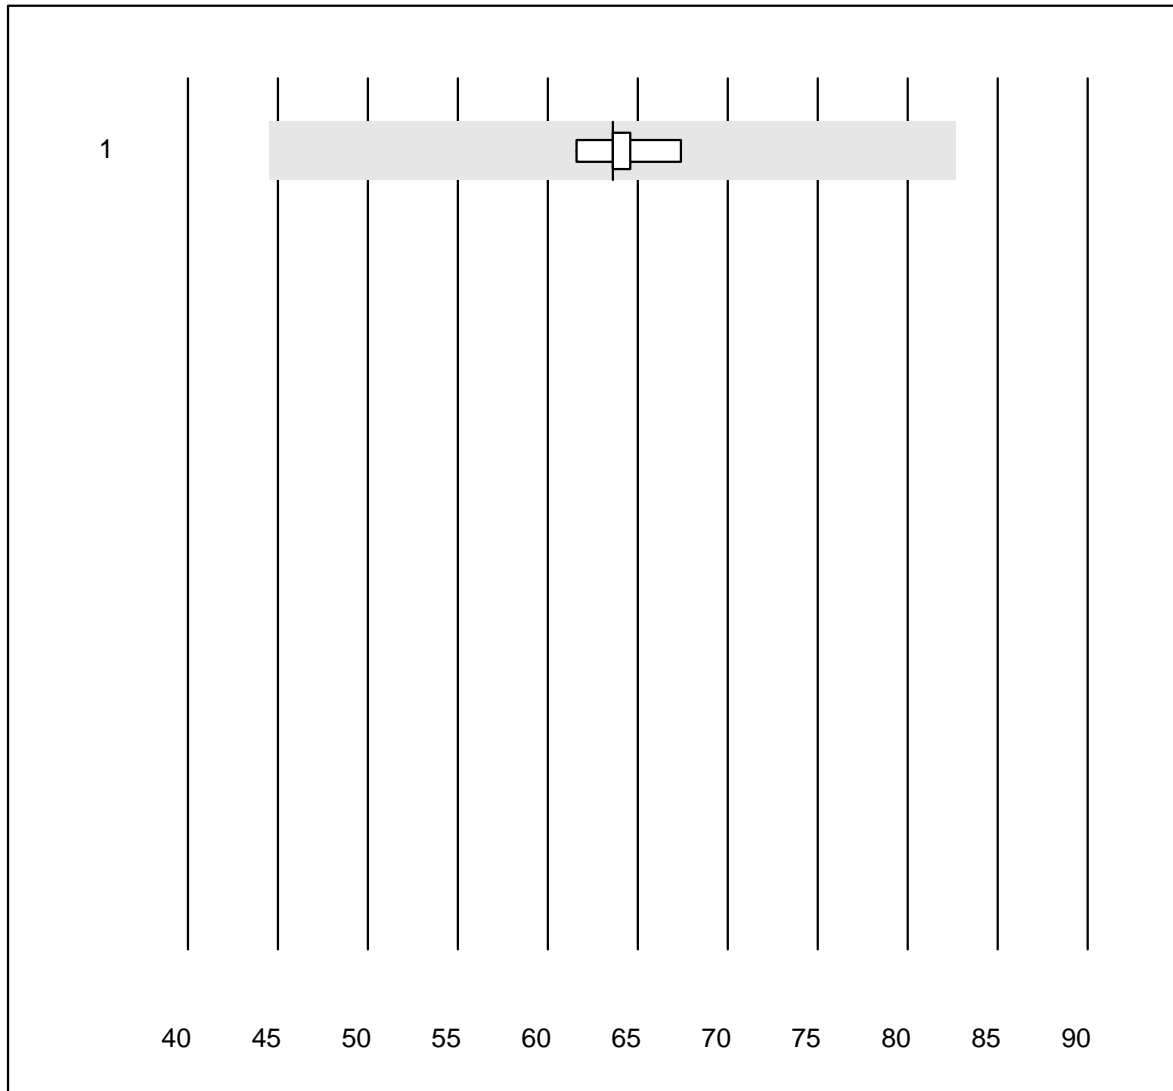


Tolérance MQ : 30 %

Progesteron (nmol/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	63.6	3.3	e

DHEAS

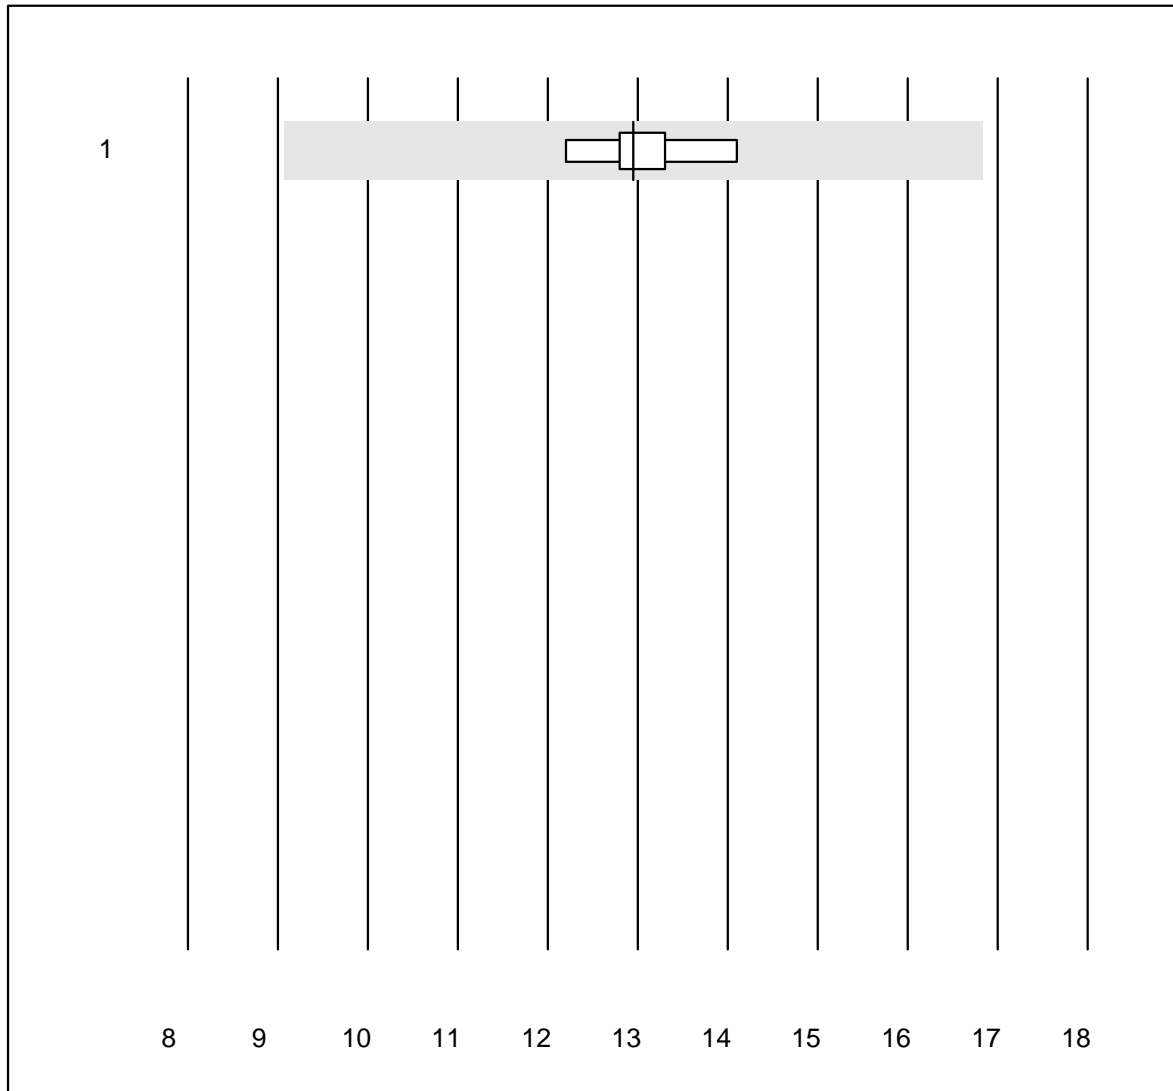


Tolérance MQ : 30 %

DHEAS (µmol/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	6	100.0	0.0	0.0	12.95	4.8	e

Luteinisierendes Hormon

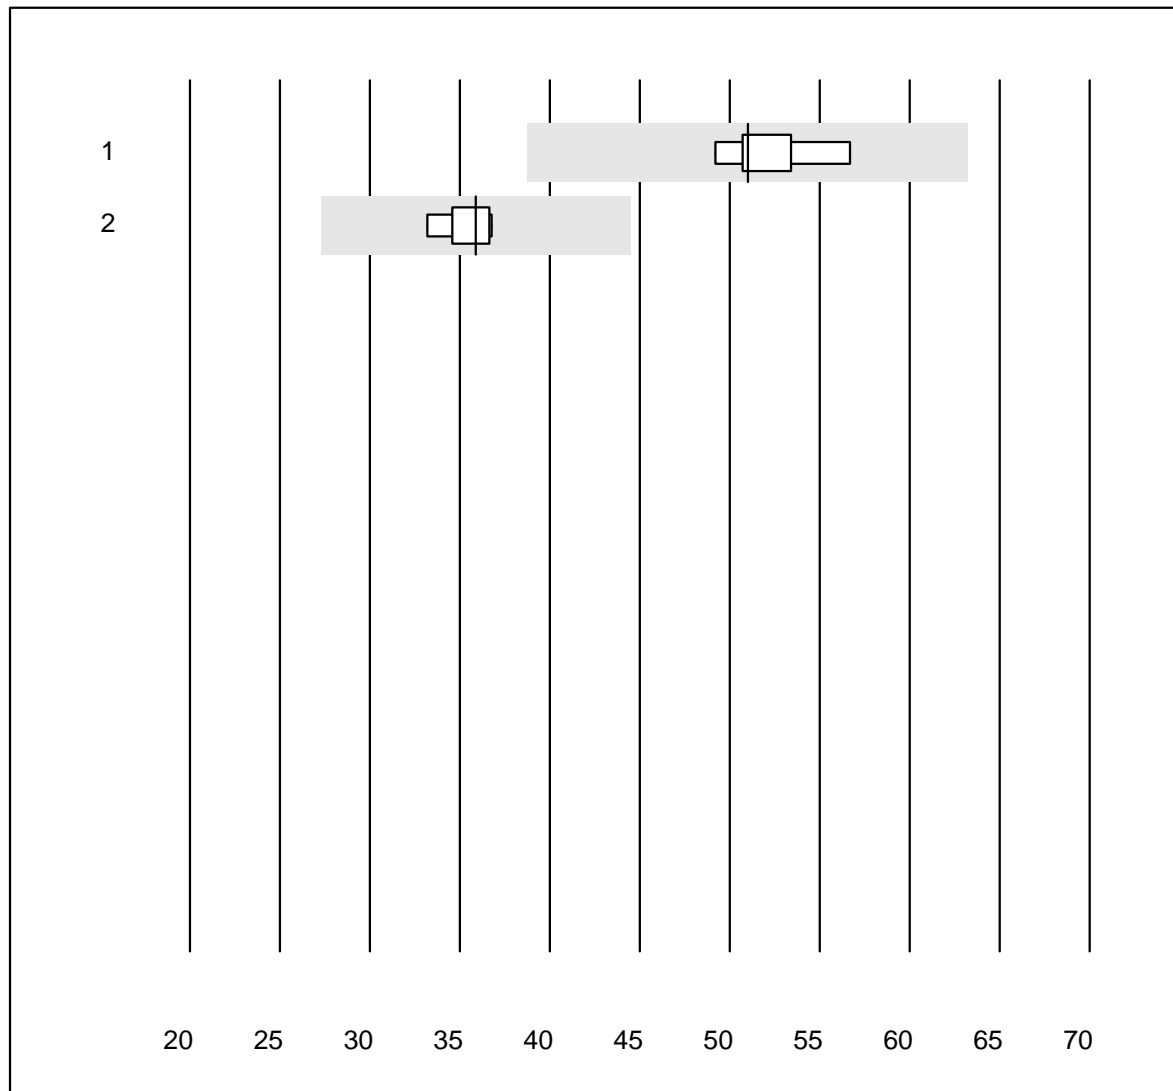


QUALAB Tolérance : 24 %

Luteinisierendes Hormon (U/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Roche, Cobas	9	100.0	0.0	0.0	51.0	4.5	e
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	35.9	4.3	e


Follikelstimulierendes Hormon

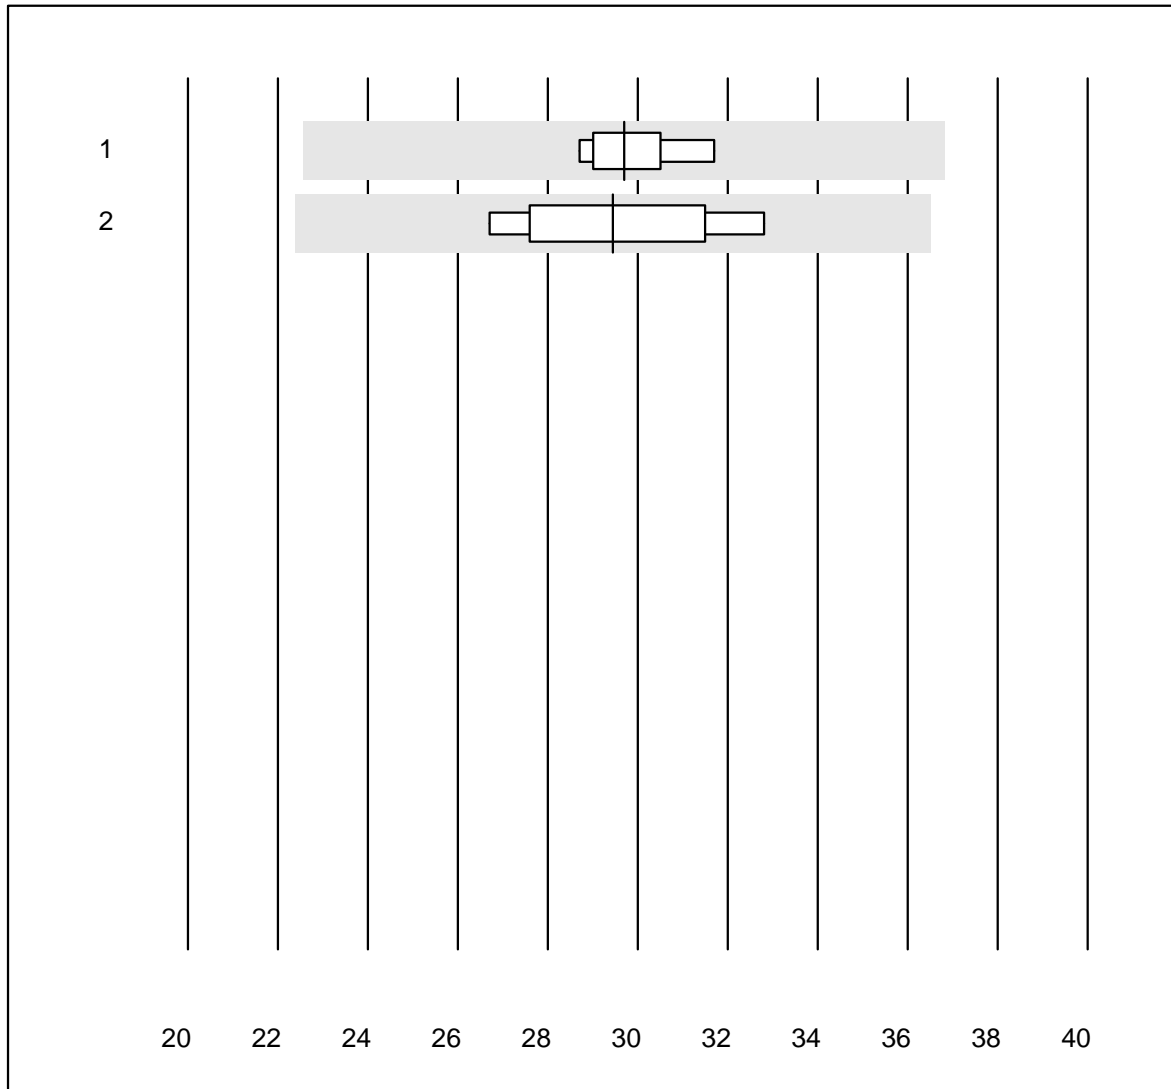

QUALAB Tolérance : 24 % Follikelstimulierendes Hormon (U/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Roche, Cobas	9	100.0	0.0	0.0	29.7	3.4	e
2 Architect	6	100.0	0.0	0.0	29.5	8.4	e*

Prolaktin (PRL)

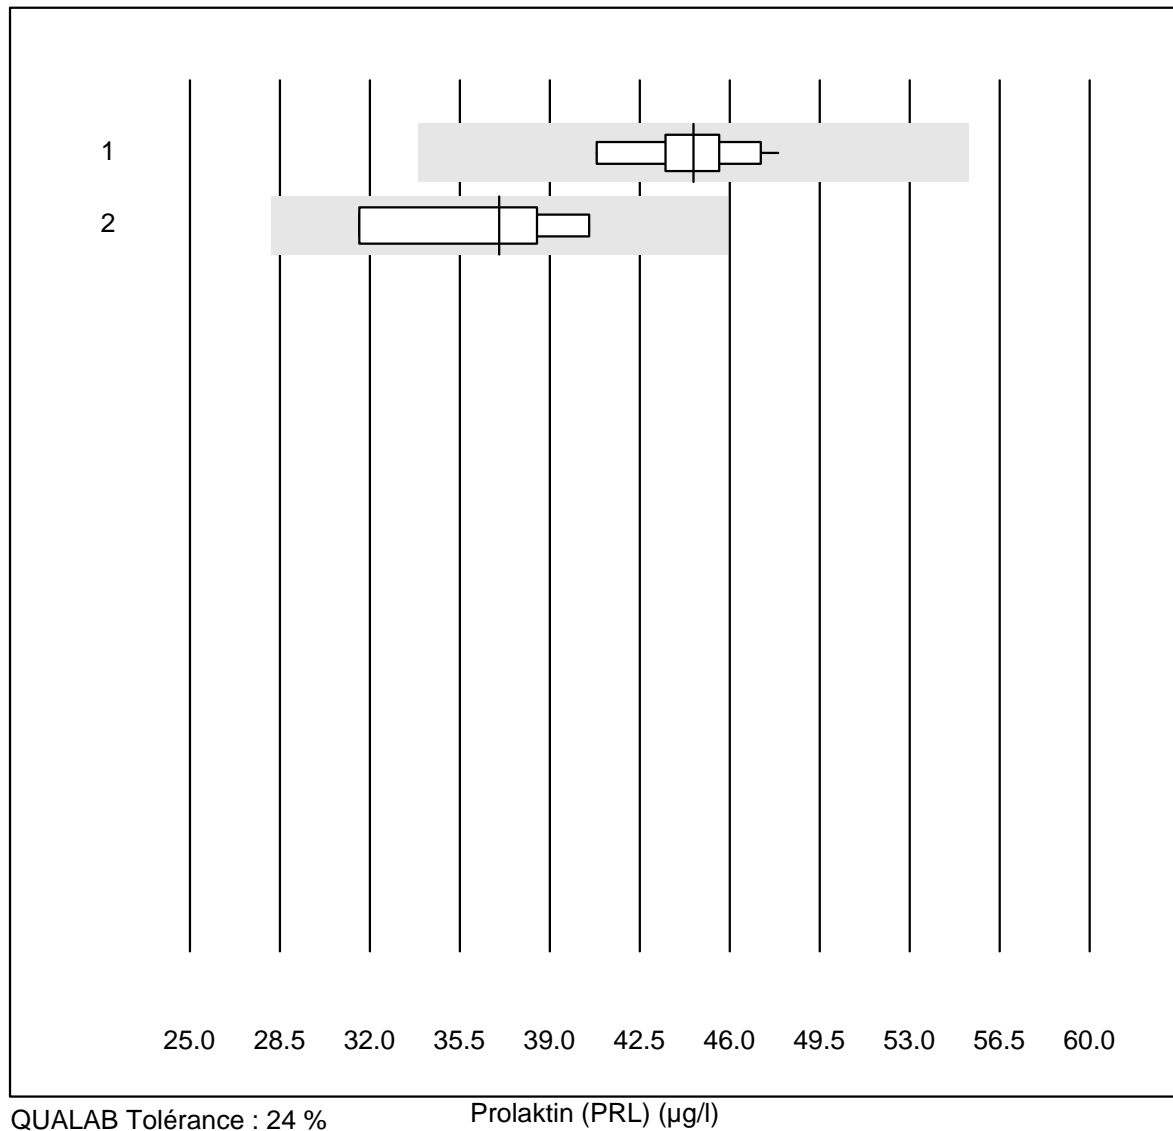


QUALAB Tolérance : 24 %

Prolaktin (PRL) (µg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas/Roche	10	100.0	0.0	0.0	44.6	4.5	e
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	37.0	10.6	e*

Insulin

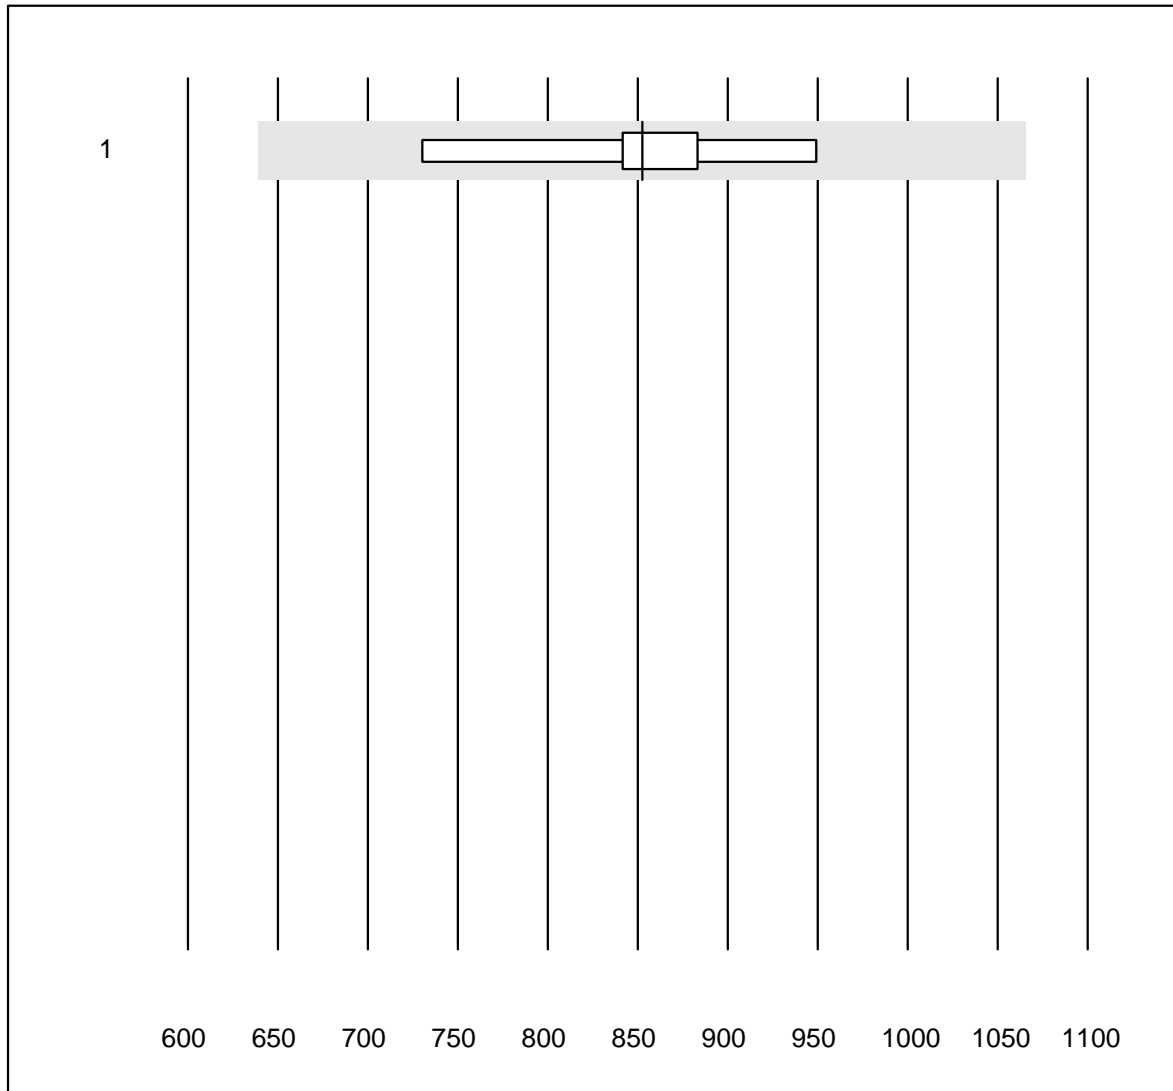


Tolérance MQ : 25 %

Insulin (pmol/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	10	90.0	0.0	10.0	852	8.0	e

HGH

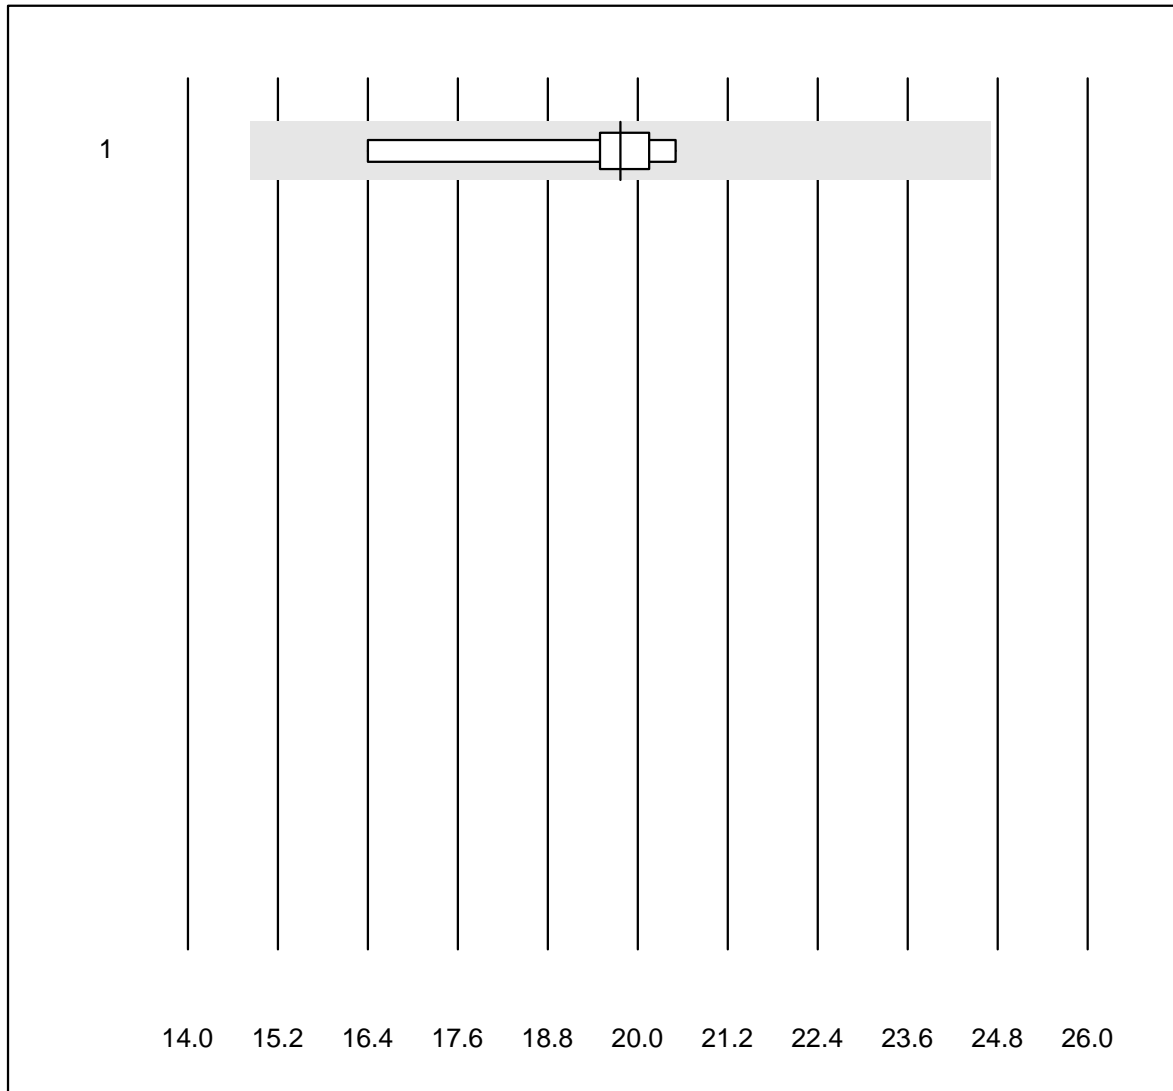


Tolérance MQ : 25 %

HGH (µg/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	6	100.0	0.0	0.0	19.76	7.7	e*

Freies Testosteron

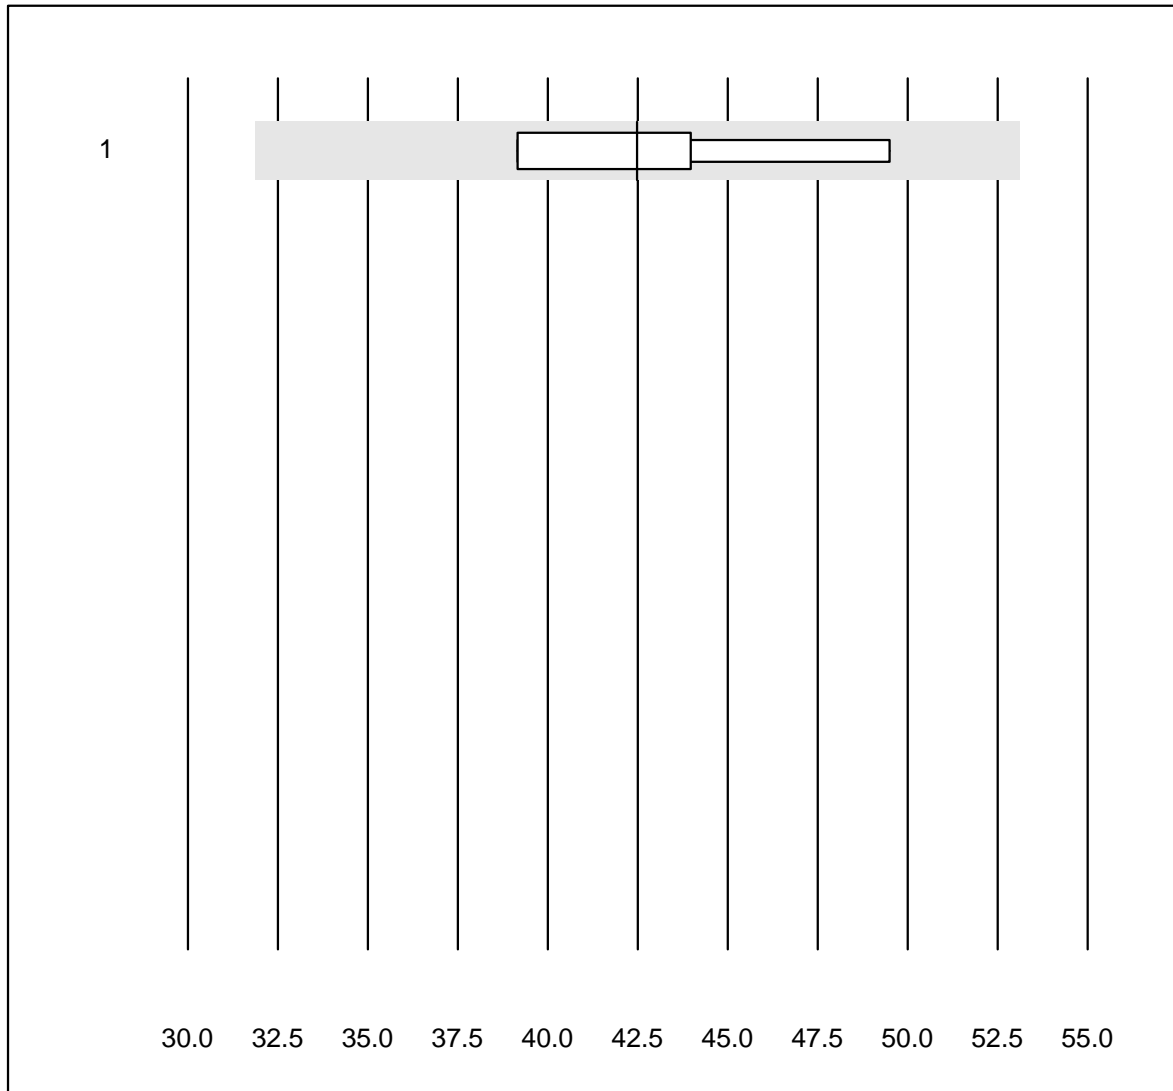


Tolérance MQ : 25 %

Freies Testosteron (pmol/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	42.5	10.4	e*

IGF-1

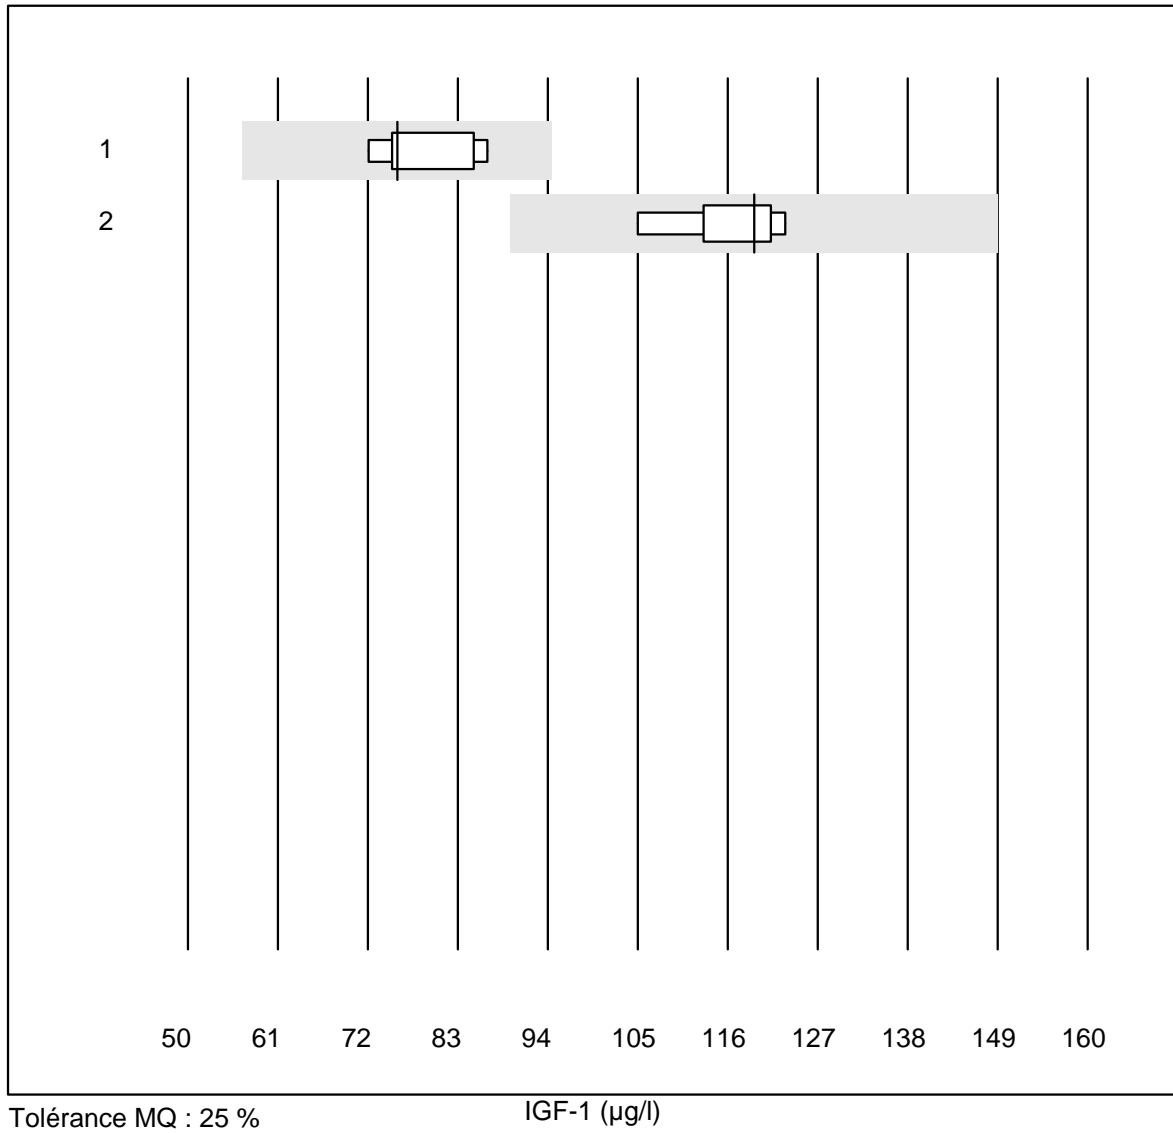


Tolérance MQ : 25 %

IGF-1 (µg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	76	8.2	e*
2 Liaison	5	100.0	0.0	0.0	119	6.3	e

Troponine T CR

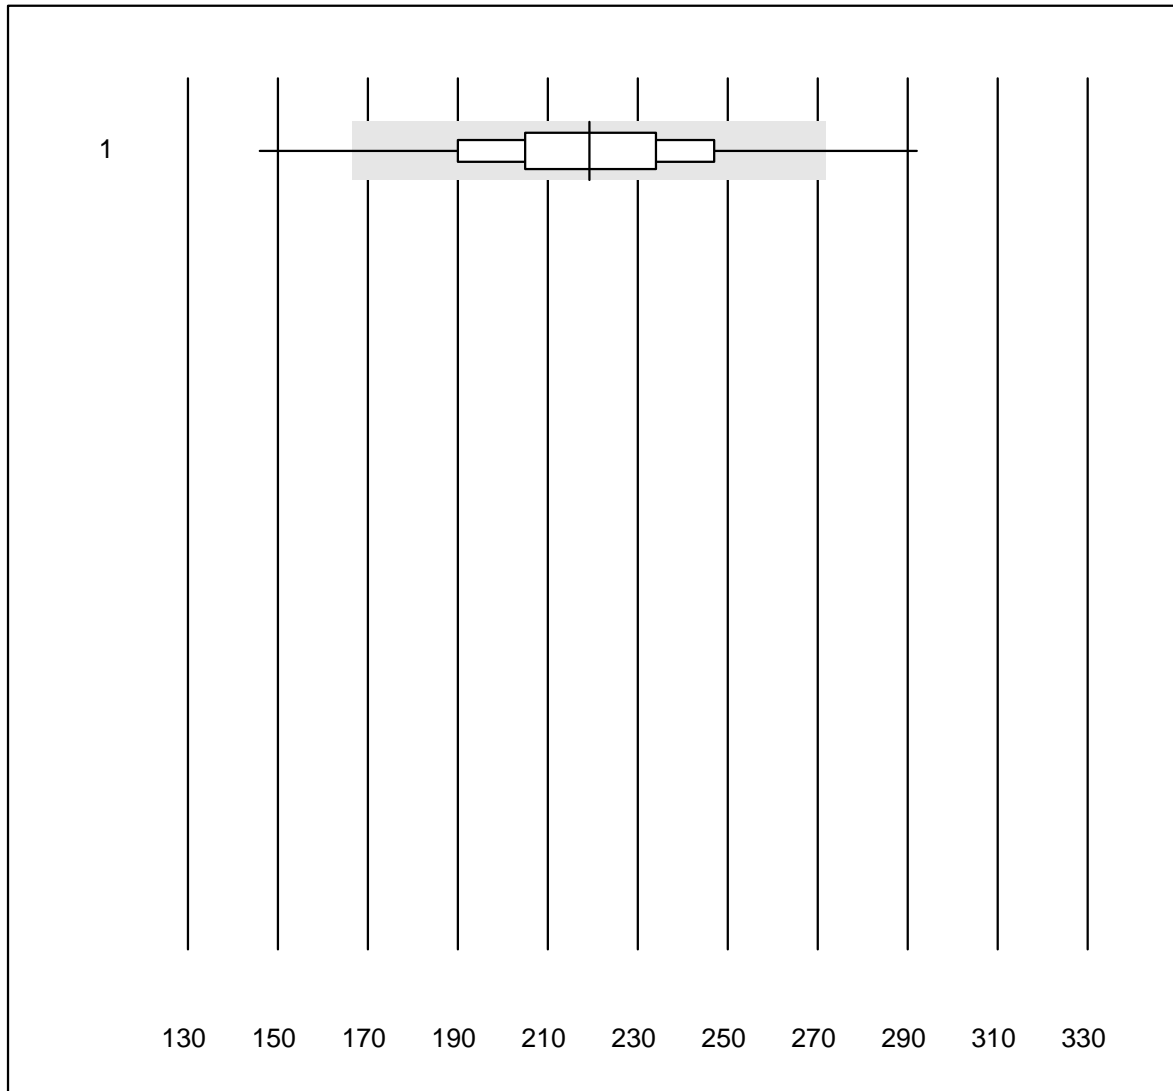


QUALAB Tolérance : 24 %

Troponine T CR (ng/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas h 232	1312	96.6	2.6	0.8	219.18	10.2	e

D-Dimères CR

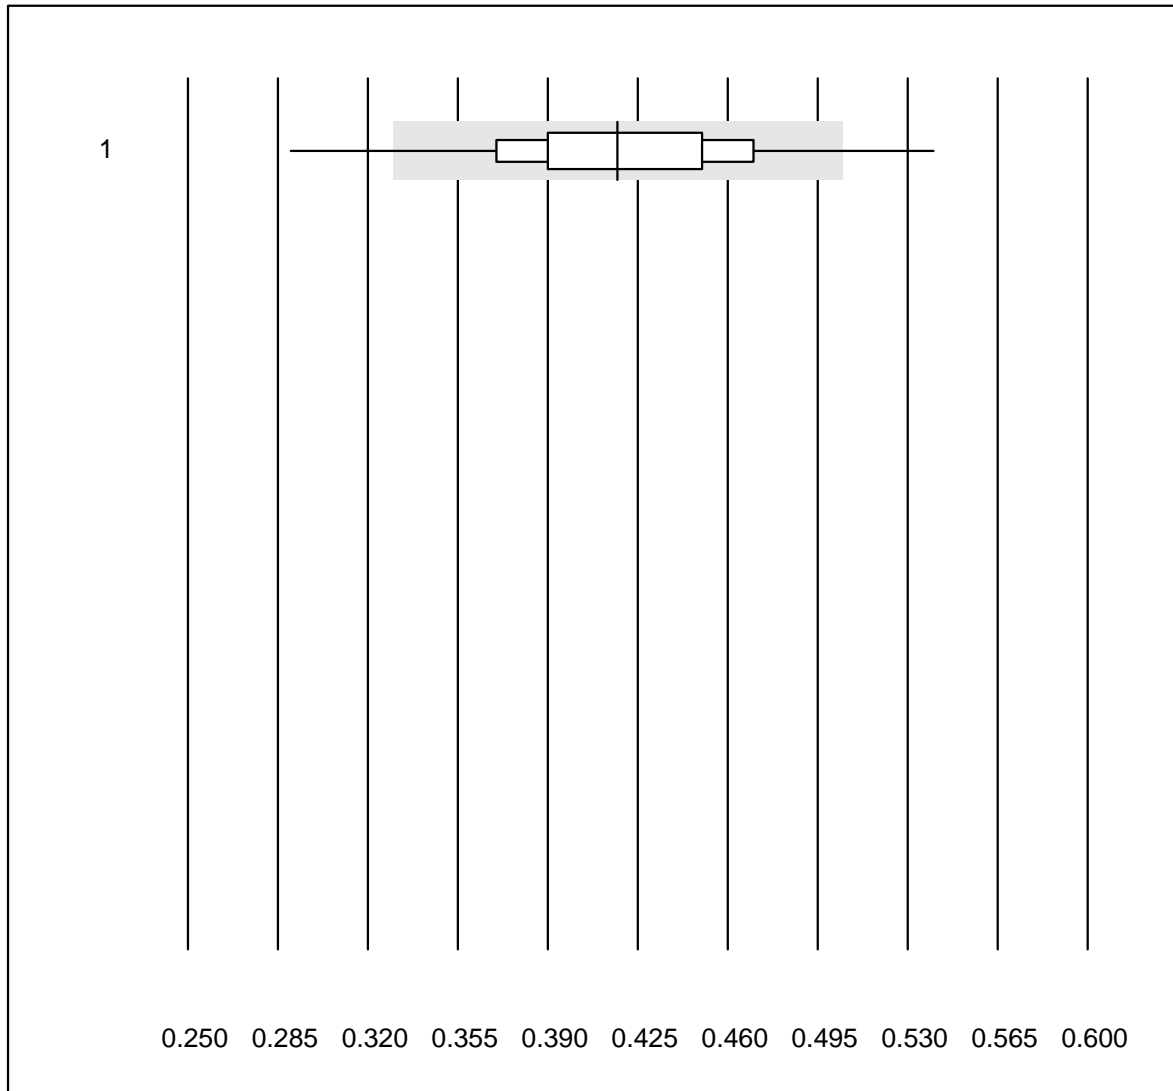


QUALAB Tolérance : 21 %

D-Dimères CR (mg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas h 232	1286	95.5	3.6	0.9	0.42	10.0	e

CKMB- K8

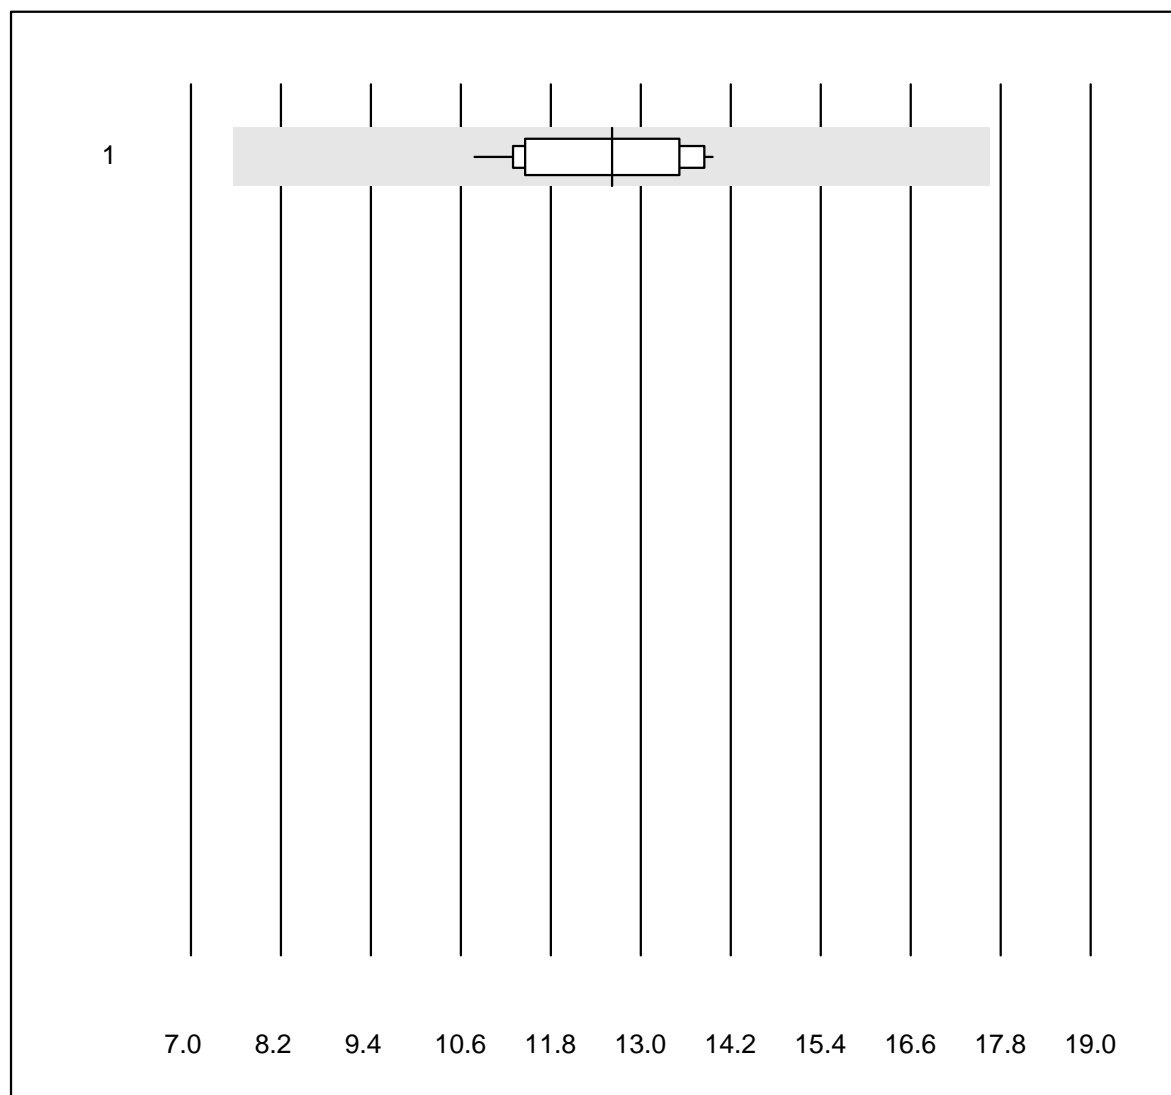


Tolérance MQ : 40 %

CKMB- K8 (µg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas h 232	13	100.0	0.0	0.0	12.6	9.0	e

NT-proBNP CR

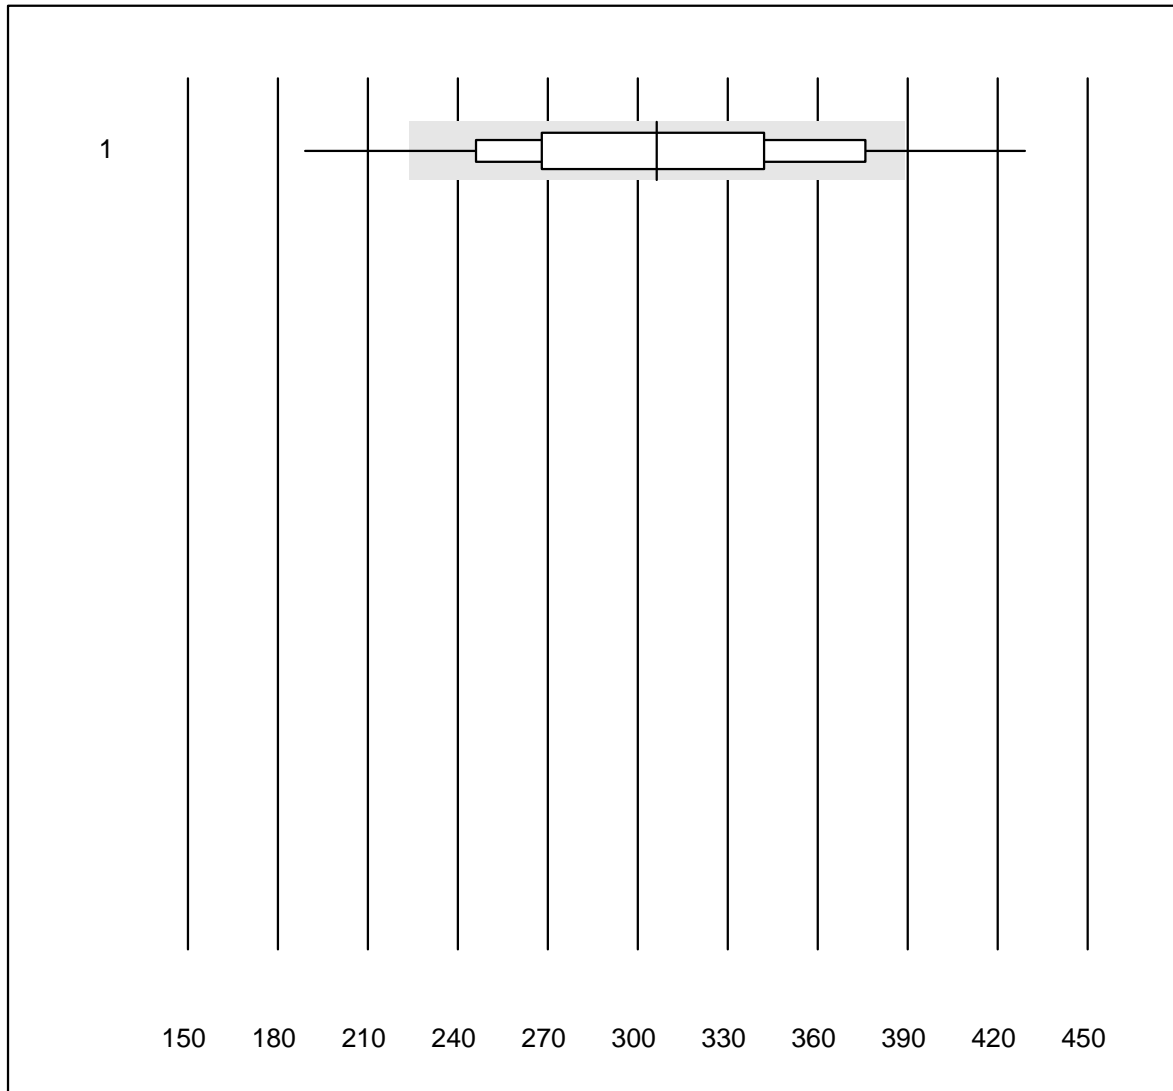


QUALAB Tolérance : 27 %

NT-proBNP CR (ng/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas h 232	805	88.8	8.6	2.6	306	16.2	e

PCO2 CCA

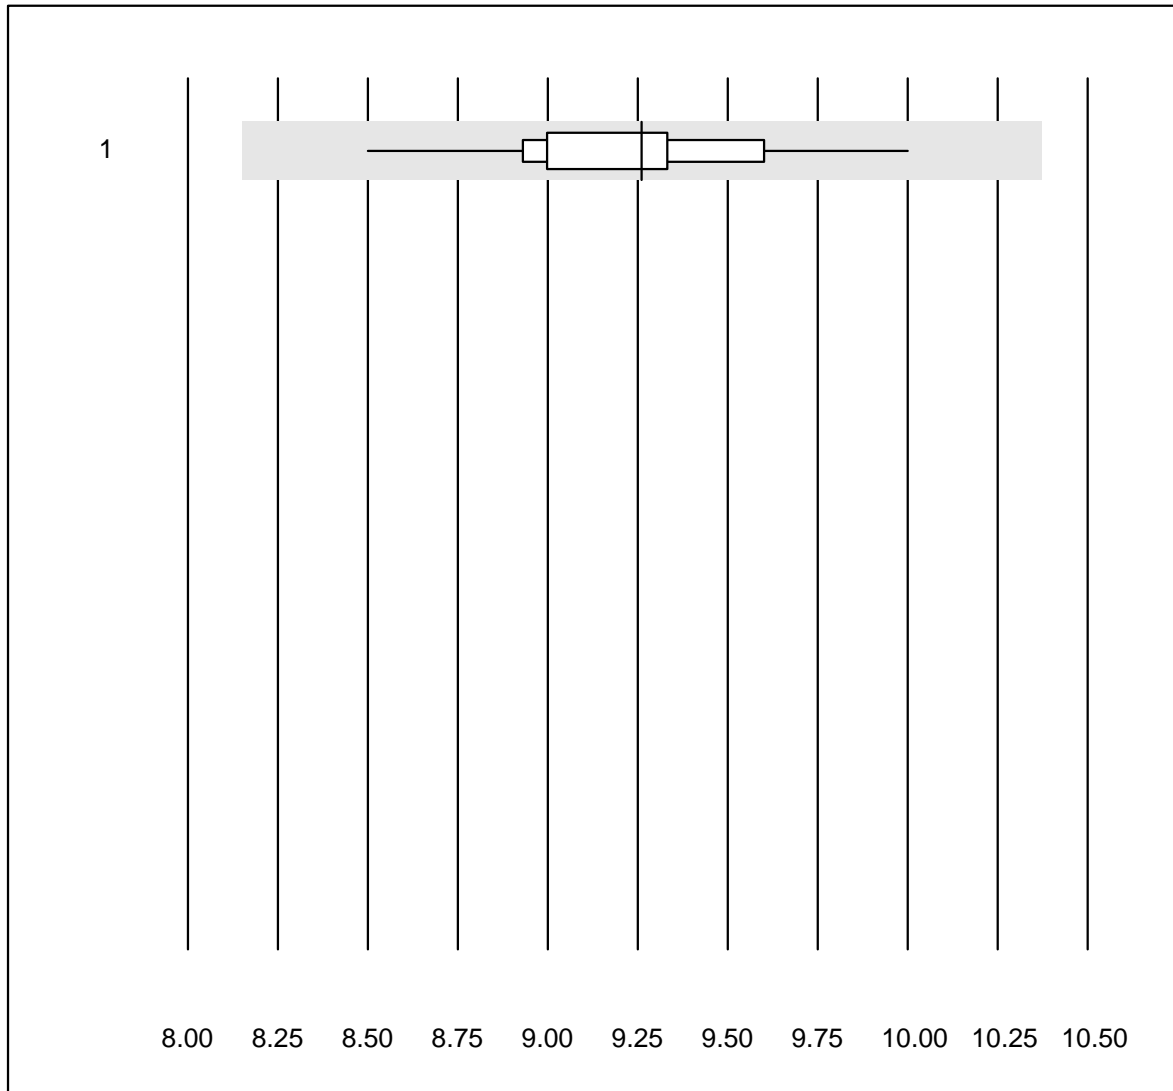


QUALAB Tolérance : 12 %

PCO2 CCA (kPa)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 OPTI CCA	12	100.0	0.0	0.0	9.26	4.1	e

PO2 CCA

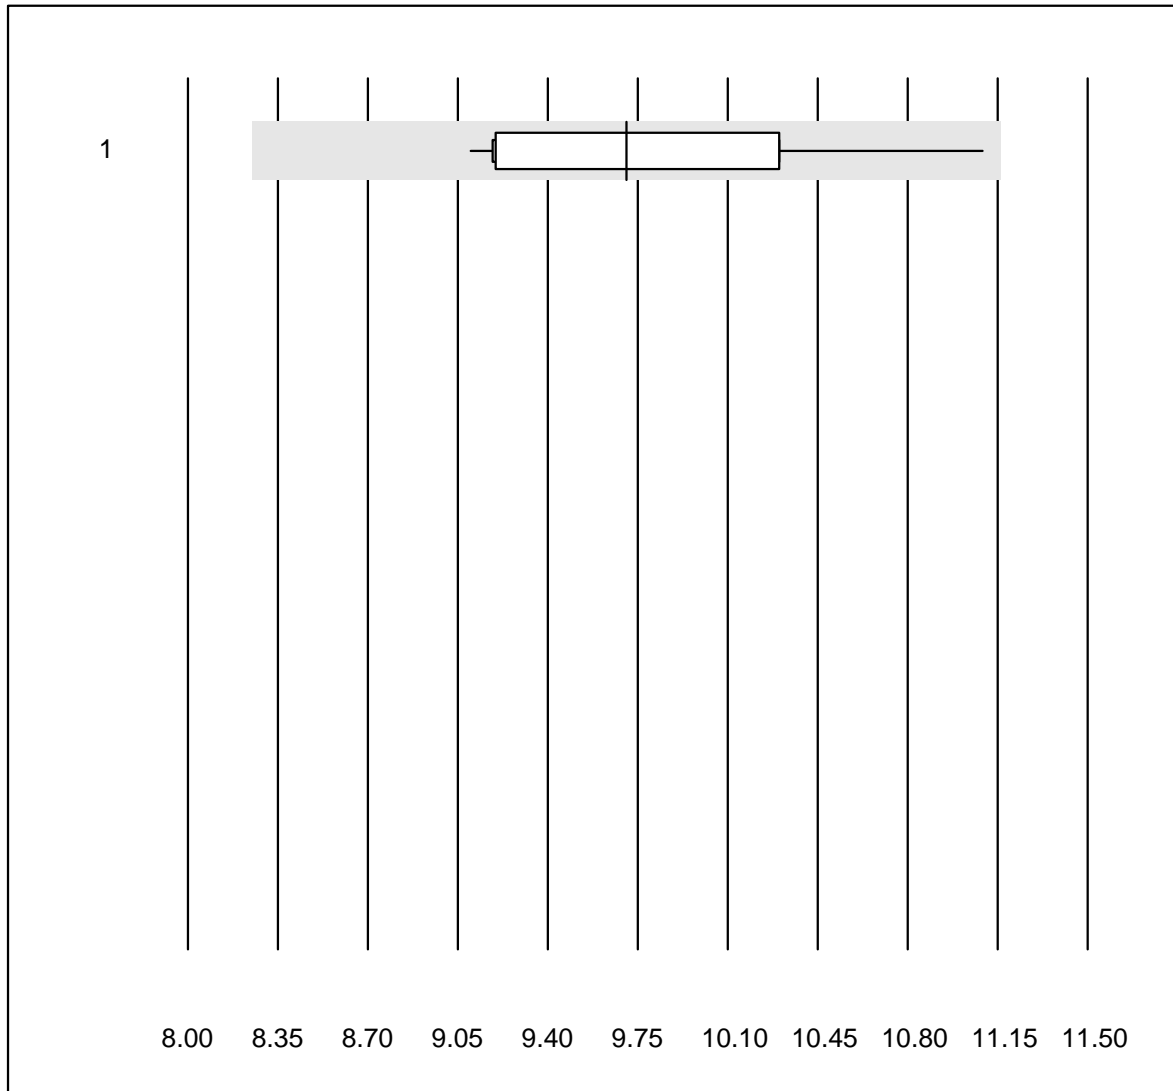


QUALAB Tolérance : 15 %

PO2 CCA (kPa)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 OPTI CCA	12	91.7	0.0	8.3	9.70	6.9	e*


pH CCA

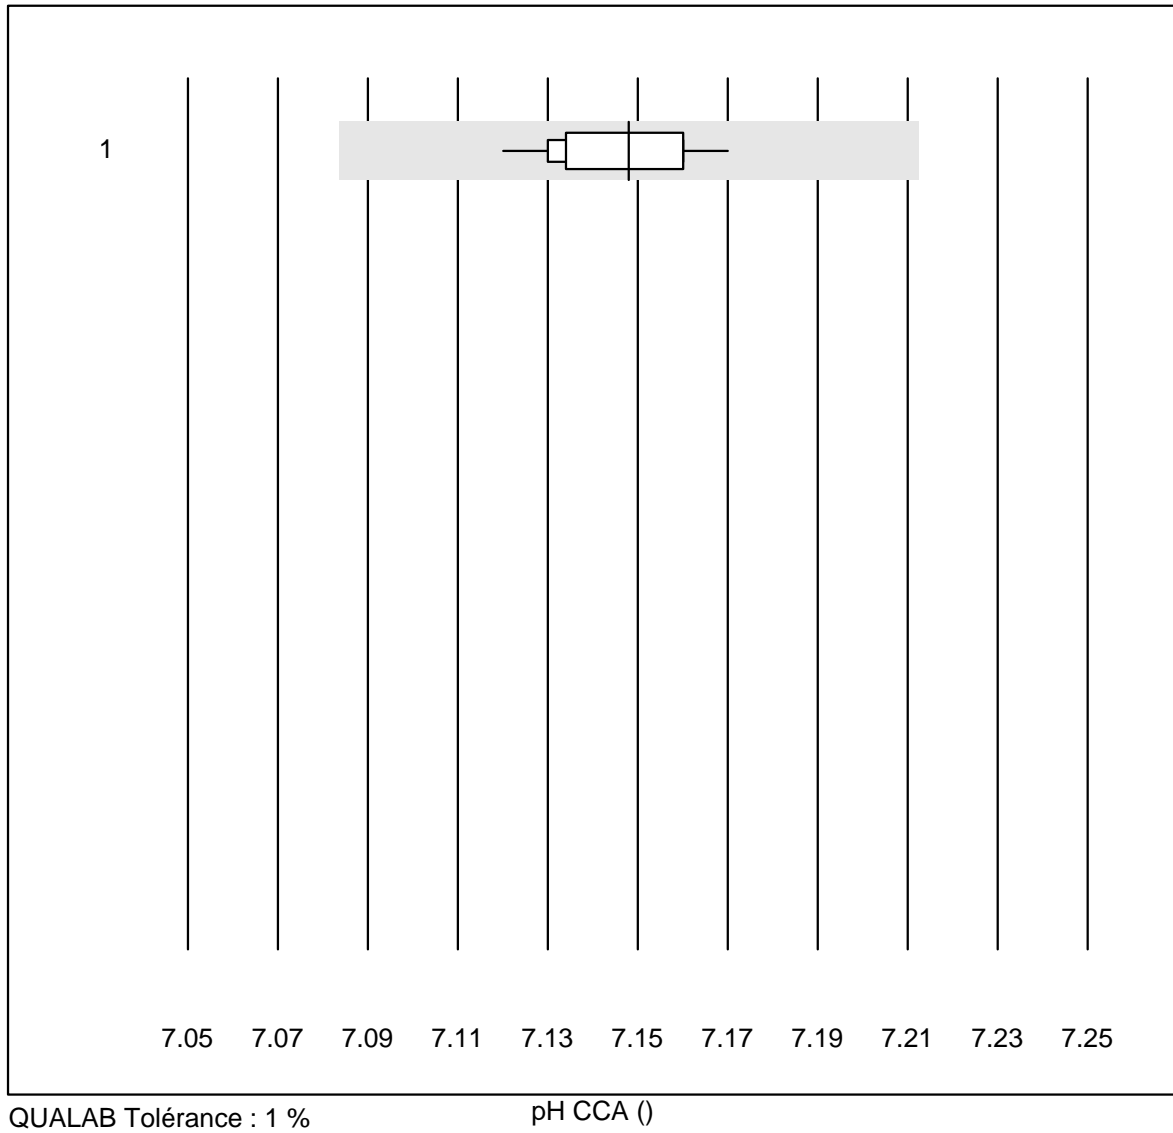

QUALAB Tolérance : 1 %

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 OPTI CCA	11	100.0	0.0	0.0	7.15	0.2	e

Potassium CCA

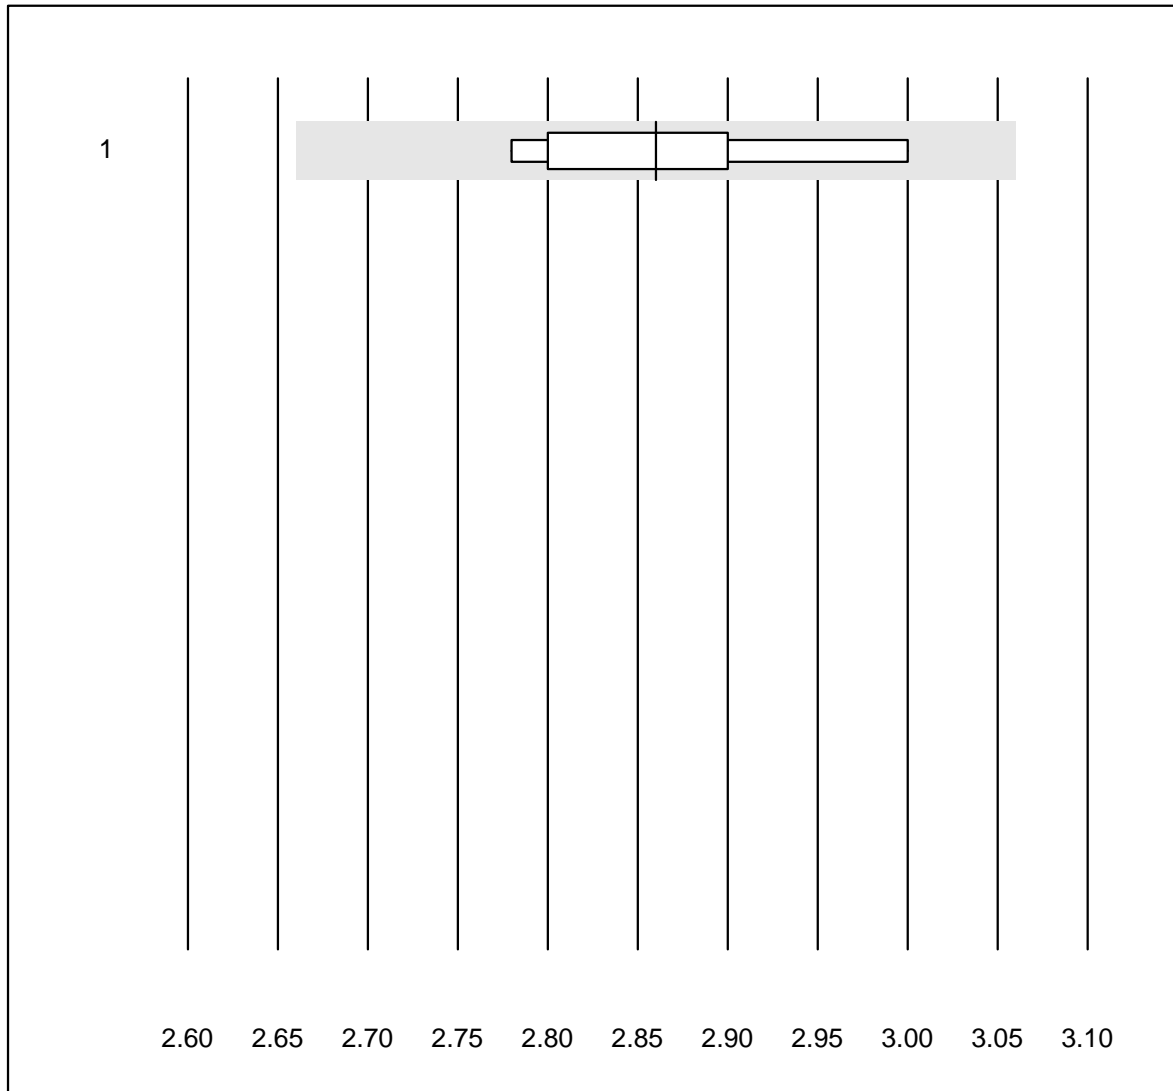


QUALAB Tolérance : 6 %
(< 3.3: +/- 0.2 mmol/l)

Potassium CCA (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 OPTI CCA	5	100.0	0.0	0.0	2.9	3.1	e*

Sodium CCA

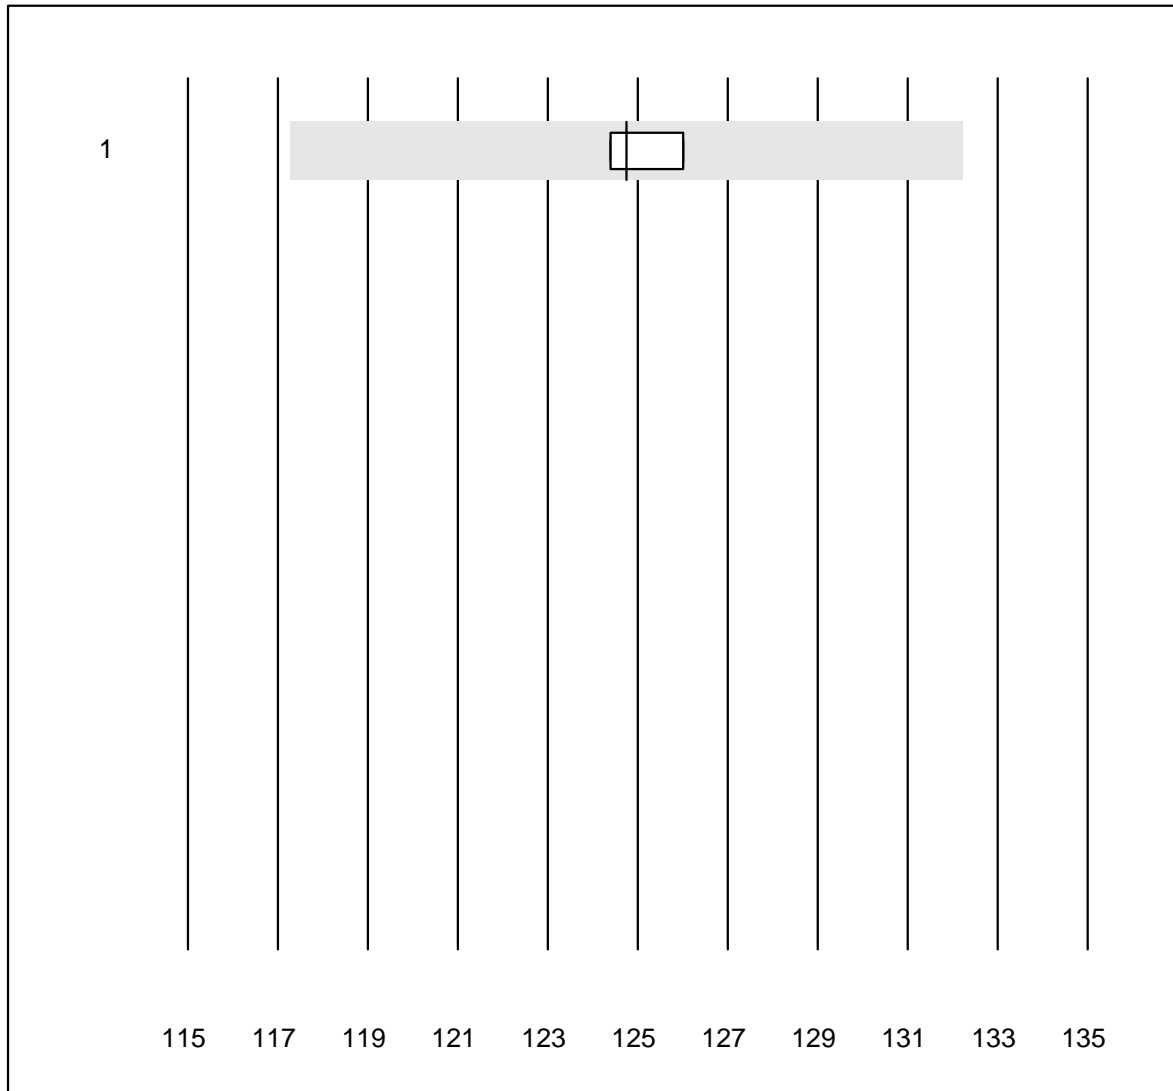


QUALAB Tolérance : 6 %

Sodium CCA (mmol/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 OPTI CCA	4	75.0	0.0	25.0	124.8	0.6	e

Ferritine

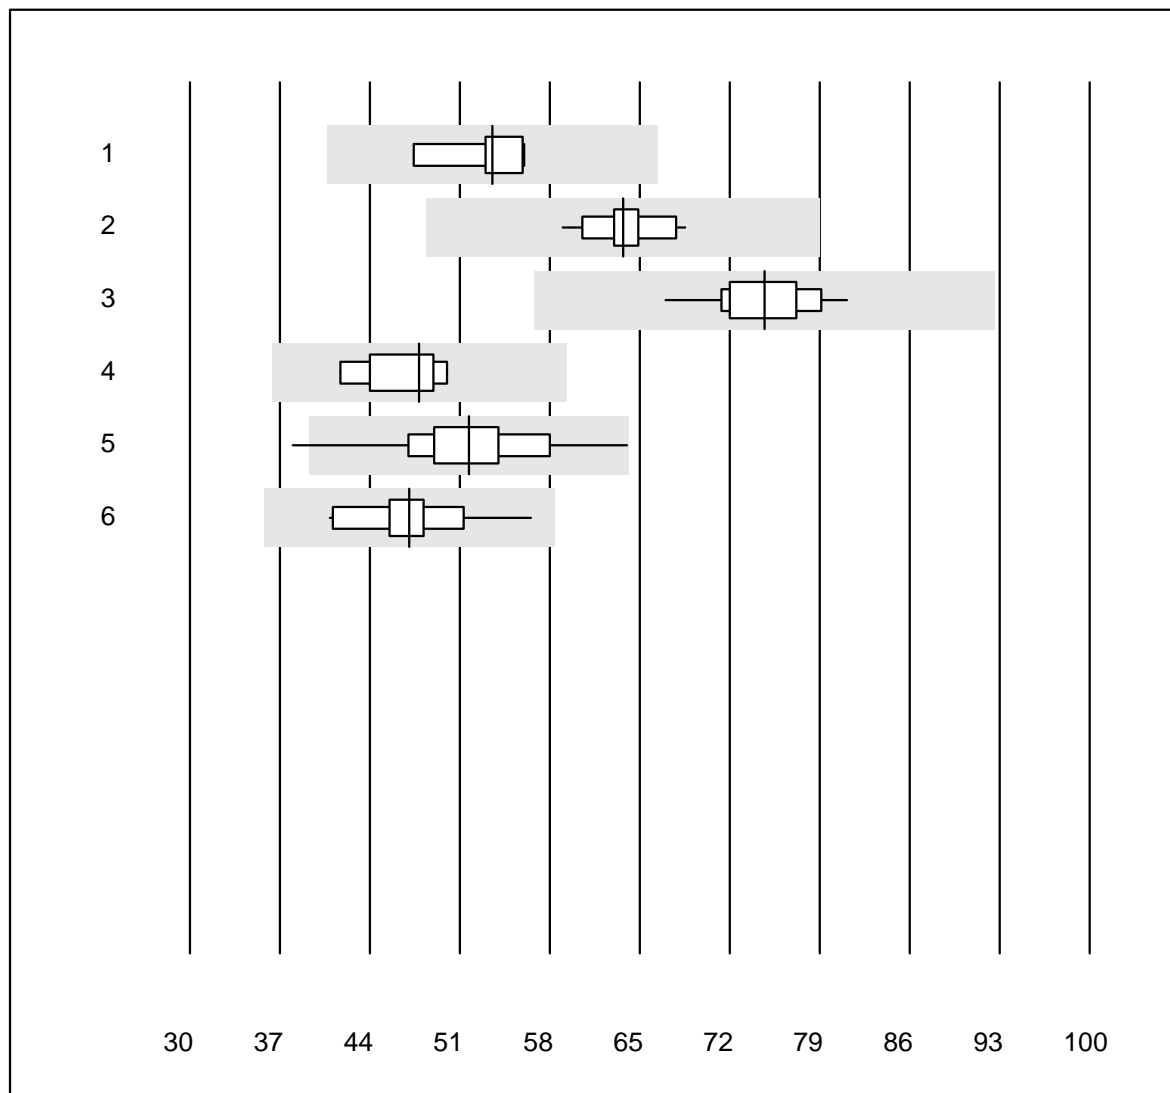


QUALAB Tolérance : 24 %

Ferritine (µg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Beckman	5	100.0	0.0	0.0	53.50	6.6	e*
2 Cobas E / Elecsys	17	100.0	0.0	0.0	63.73	3.8	e
3 Architect	12	100.0	0.0	0.0	74.69	5.3	e
4 Mini Vidas	8	100.0	0.0	0.0	47.80	6.1	e
5 AFIAS	42	97.6	2.4	0.0	51.69	9.3	e
6 Eurolyser	18	94.4	0.0	5.6	47.06	7.6	e

Vitamine B12

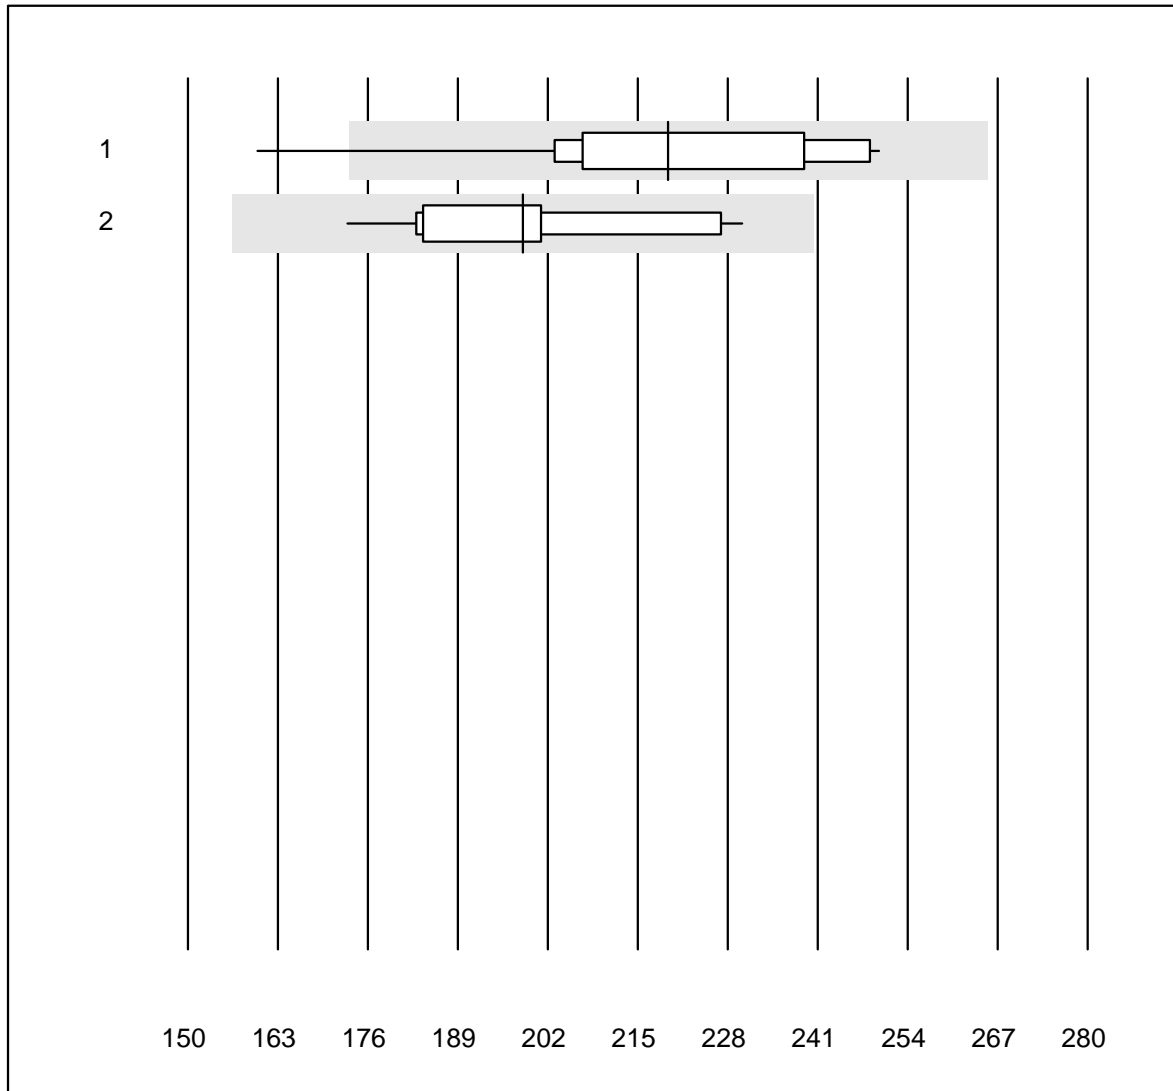


QUALAB Tolérance : 21 %
 (< 200.00: +/- 42.00 pmol/l)

Vitamine B12 (pmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	16	93.7	6.3	0.0	219.36	10.5	e*
2 Architect	12	100.0	0.0	0.0	198.44	8.6	e

Folate

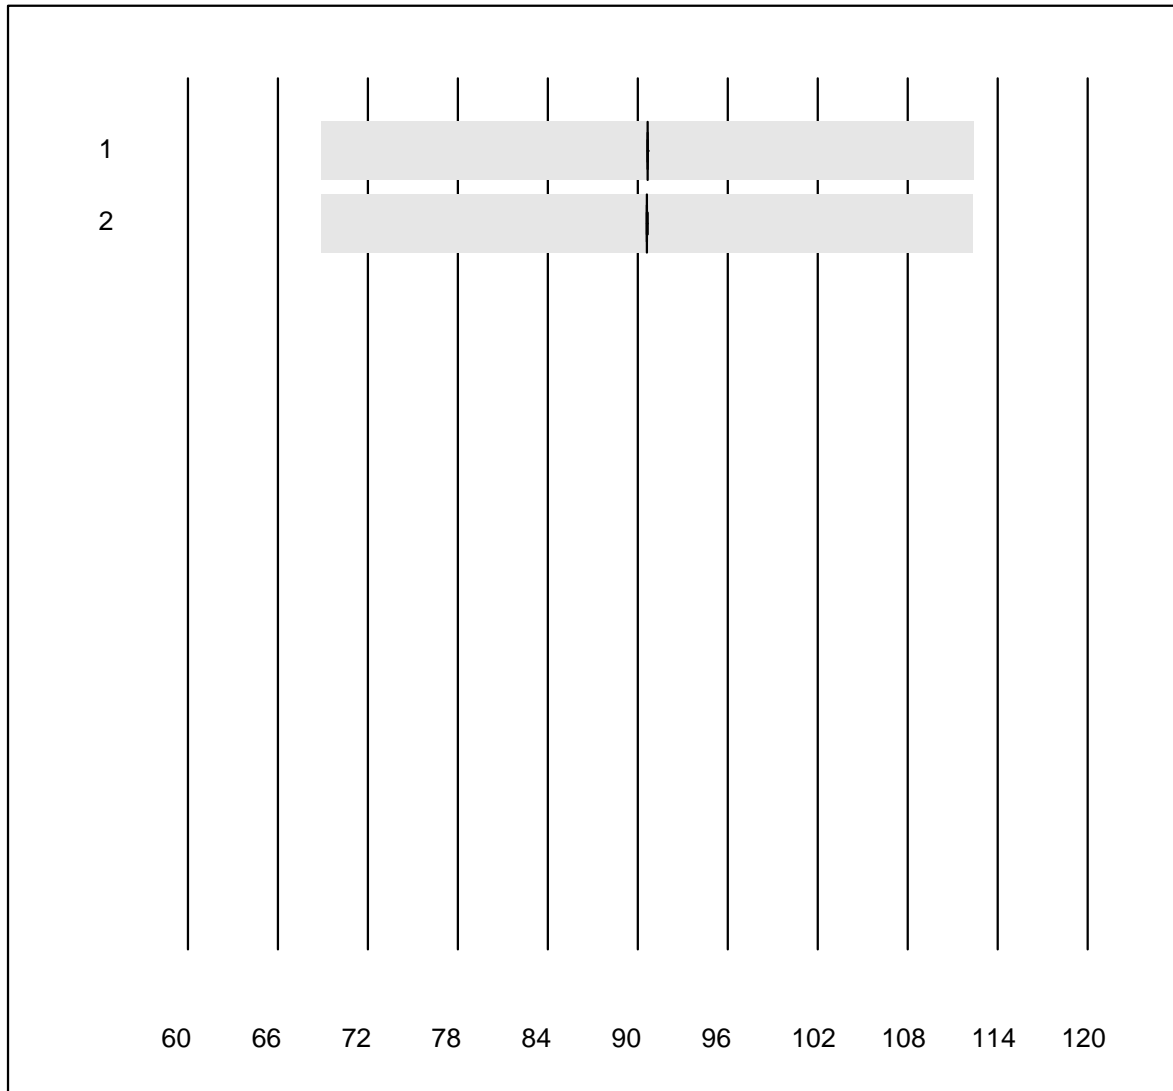


QUALAB Tolérance : 24 %

Folate (nmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	17	100.0	0.0	0.0	90.64	0.0	e
2 Architect	10	100.0	0.0	0.0	90.61	0.0	e

Holotranscobalamine

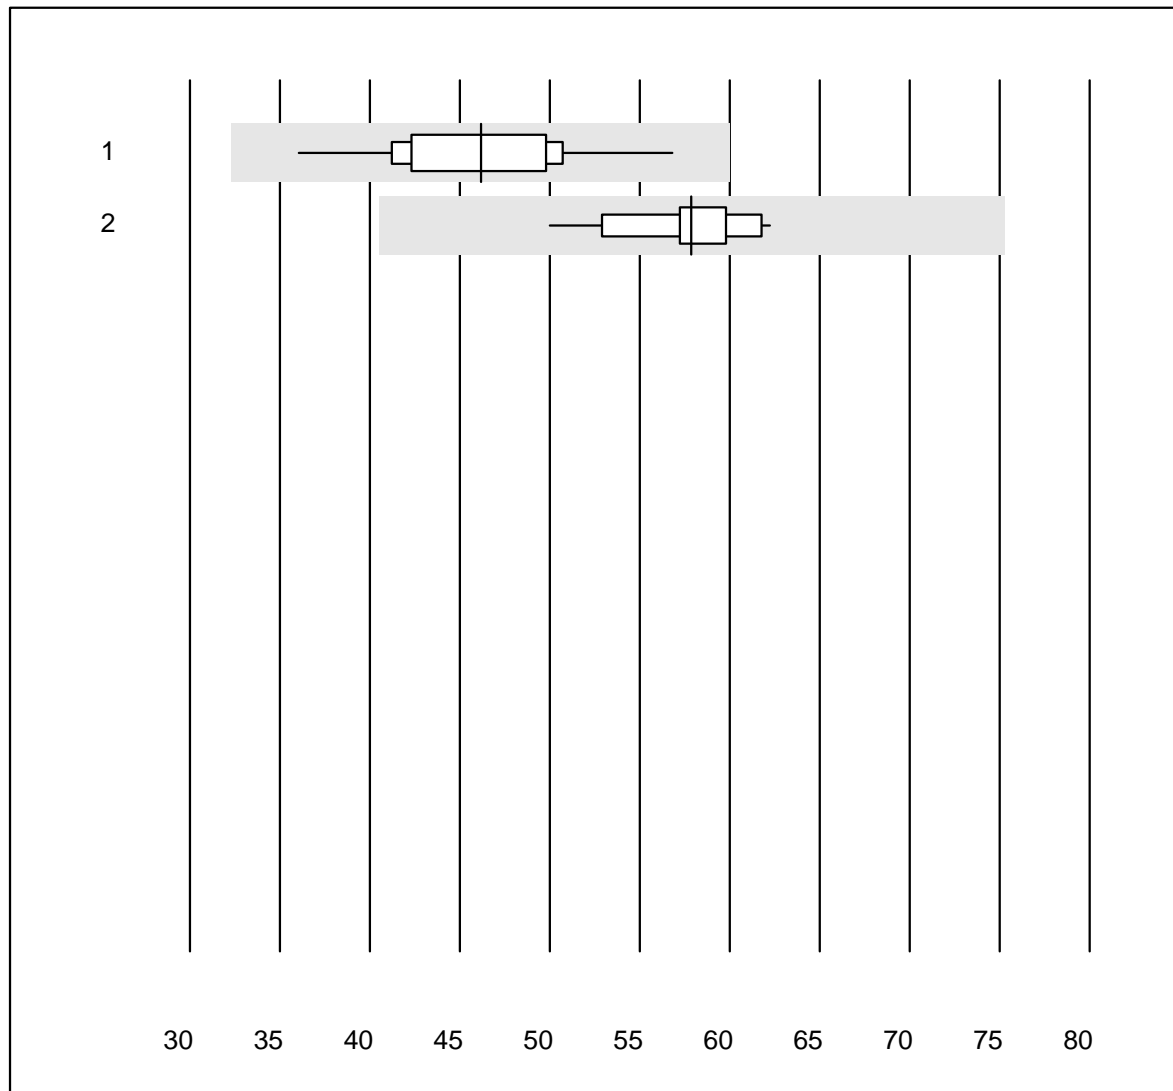


Tolérance MQ : 30 %

Holotranscobalamine (pmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Architect	15	100.0	0.0	0.0	46.2	10.7	e
2 toutes les méthodes	18	94.4	0.0	5.6	57.9	5.3	e

Bilirubin totale Neo

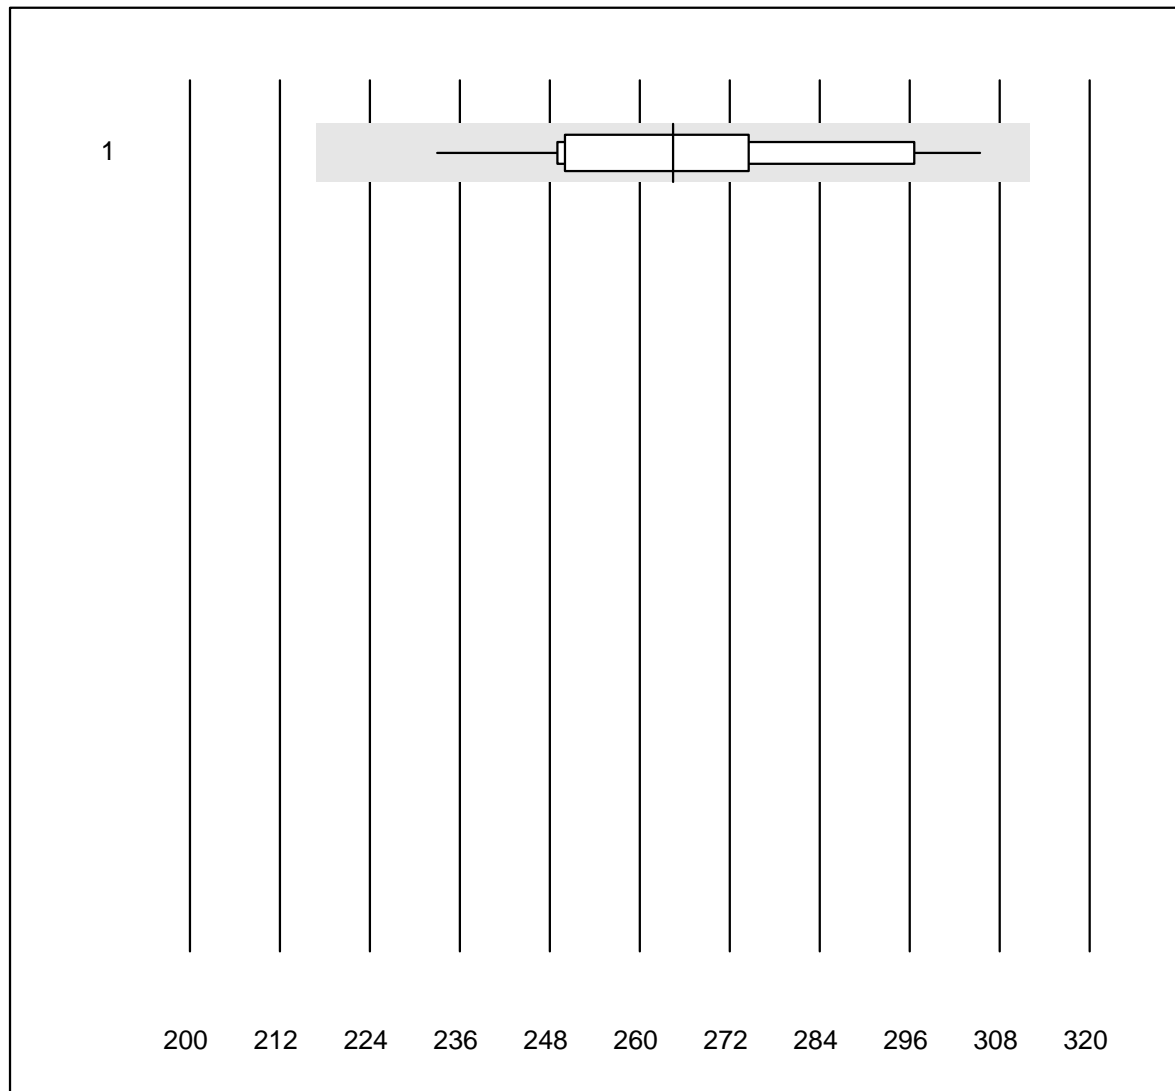


QUALAB Tolérance : 18 %

Bilirubin totale Neo (µmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	13	100.0	0.0	0.0	264	7.7	e

Bilirubin directe

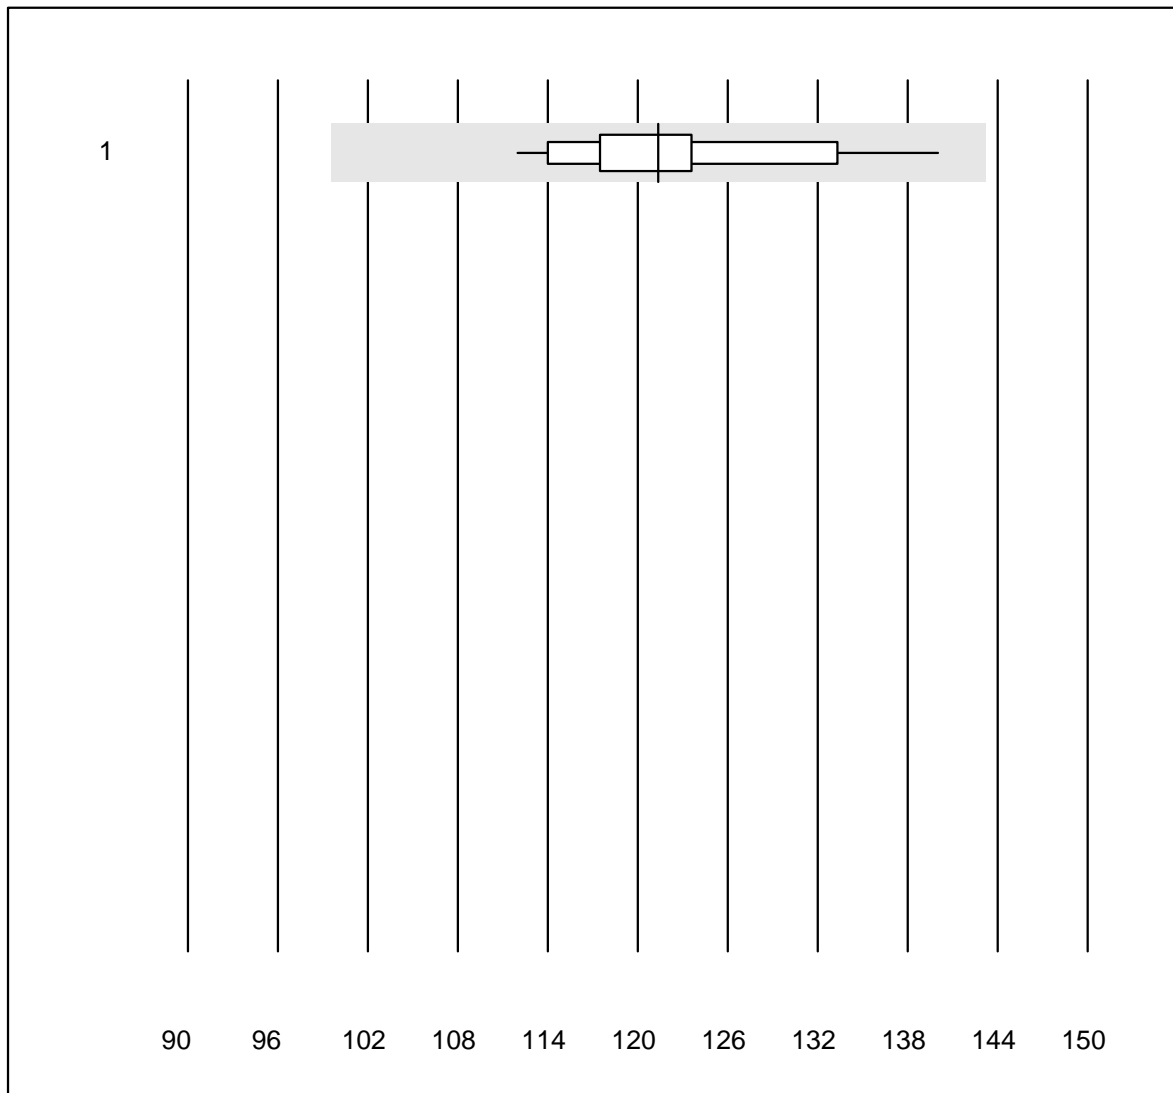


QUALAB Tolérance : 18 %

Bilirubin directe (µmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	14	92.9	0.0	7.1	121	6.5	e

Bilirubin néonatale

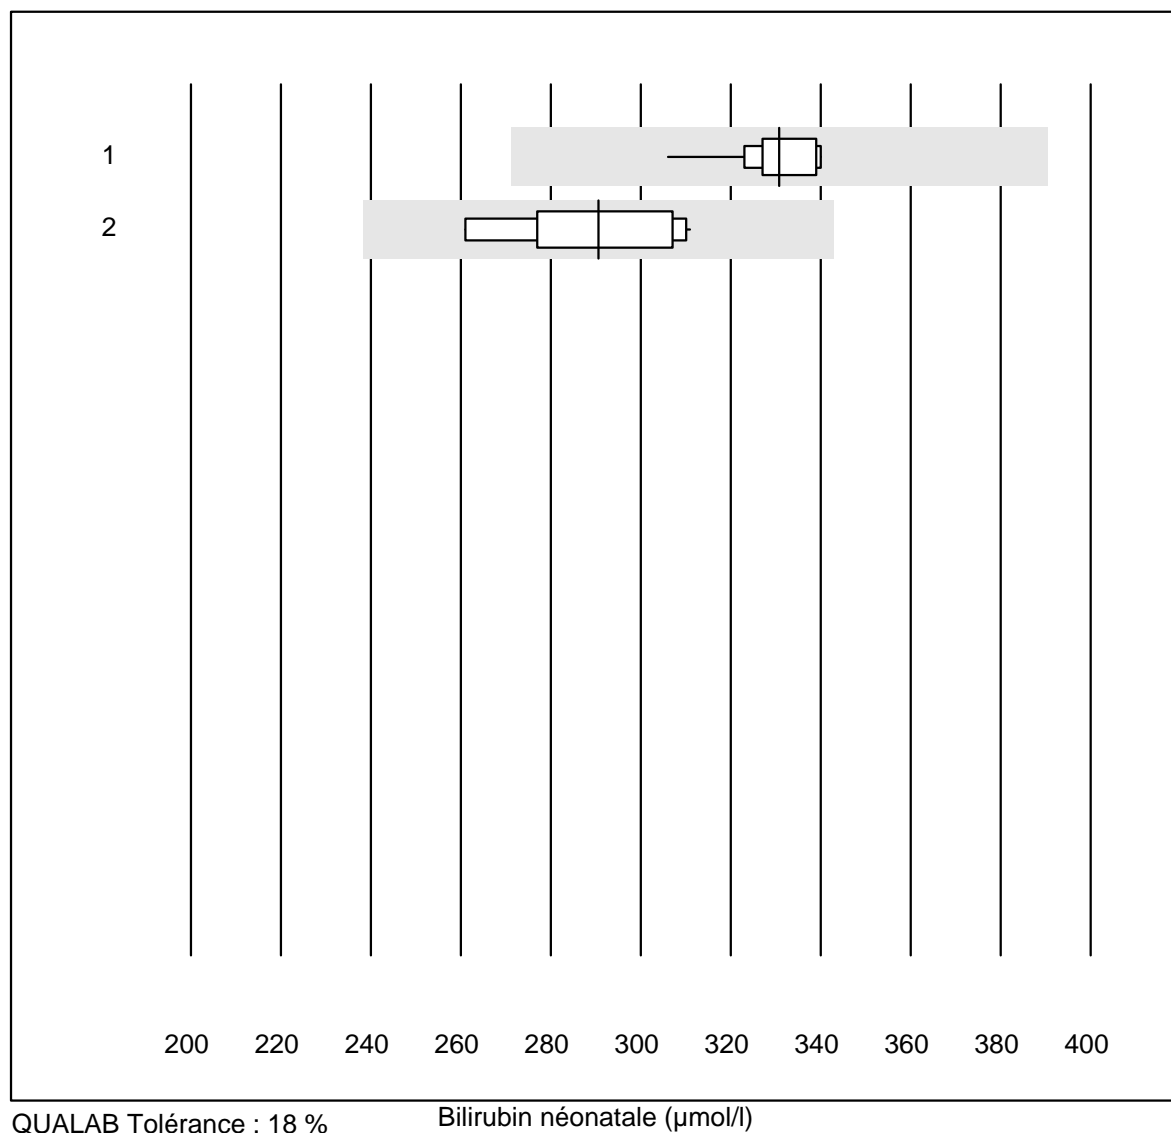


QUALAB Tolérance : 18 %

Bilirubin néonatale (µmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	11	100.0	0.0	0.0	331	3.0	e
2 ABL700/800	10	100.0	0.0	0.0	291	6.1	e

PSA

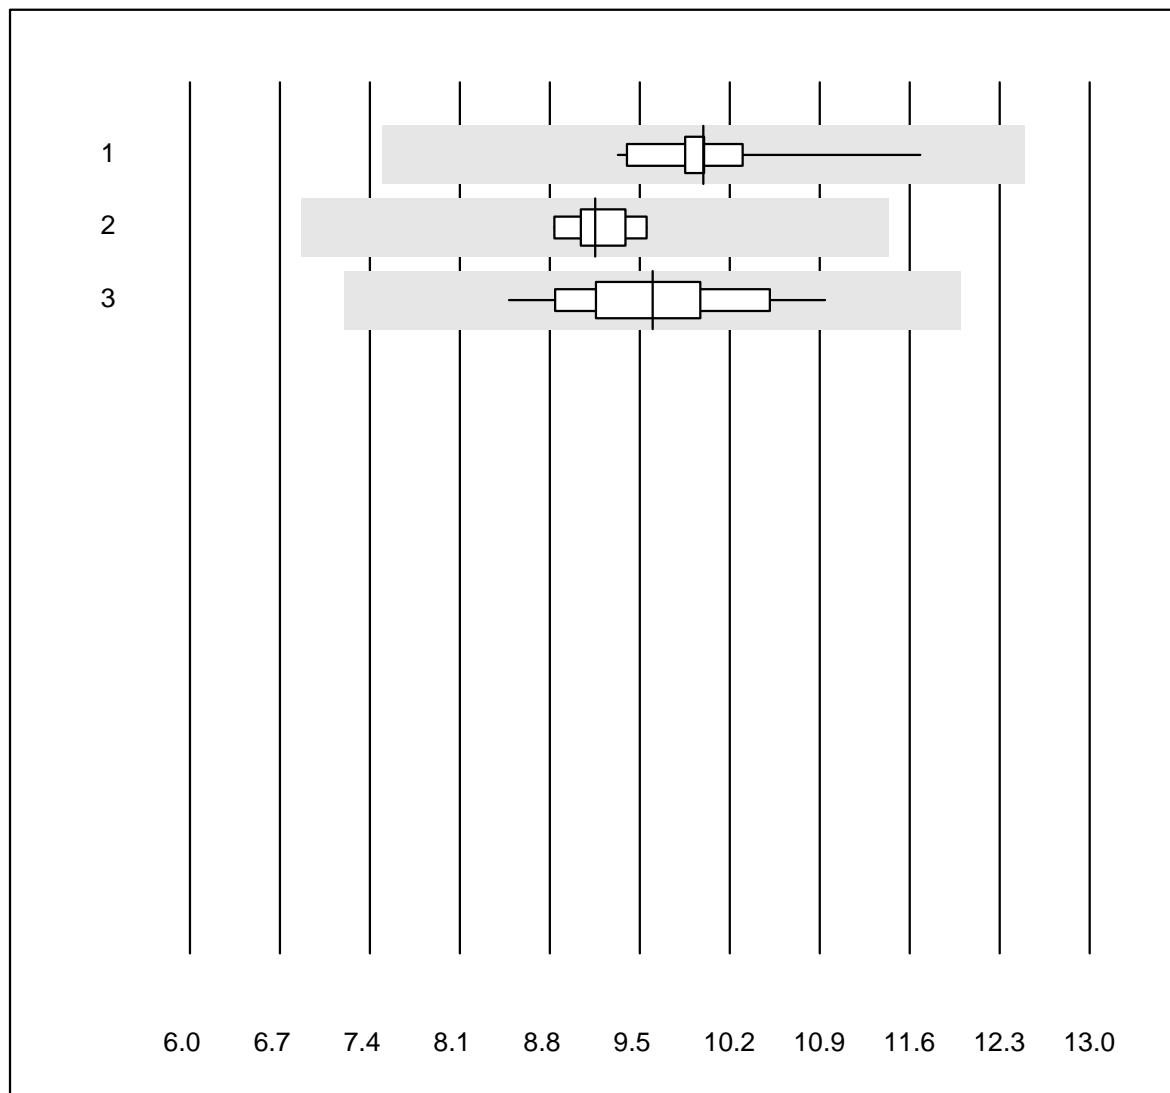


QUALAB Tolérance : 25 %

PSA (µg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	16	100.0	0.0	0.0	9.99	5.1	e
2 Architect	7	100.0	0.0	0.0	9.15	2.6	e
3 AFIAS	25	100.0	0.0	0.0	9.60	6.4	e

PSA frei

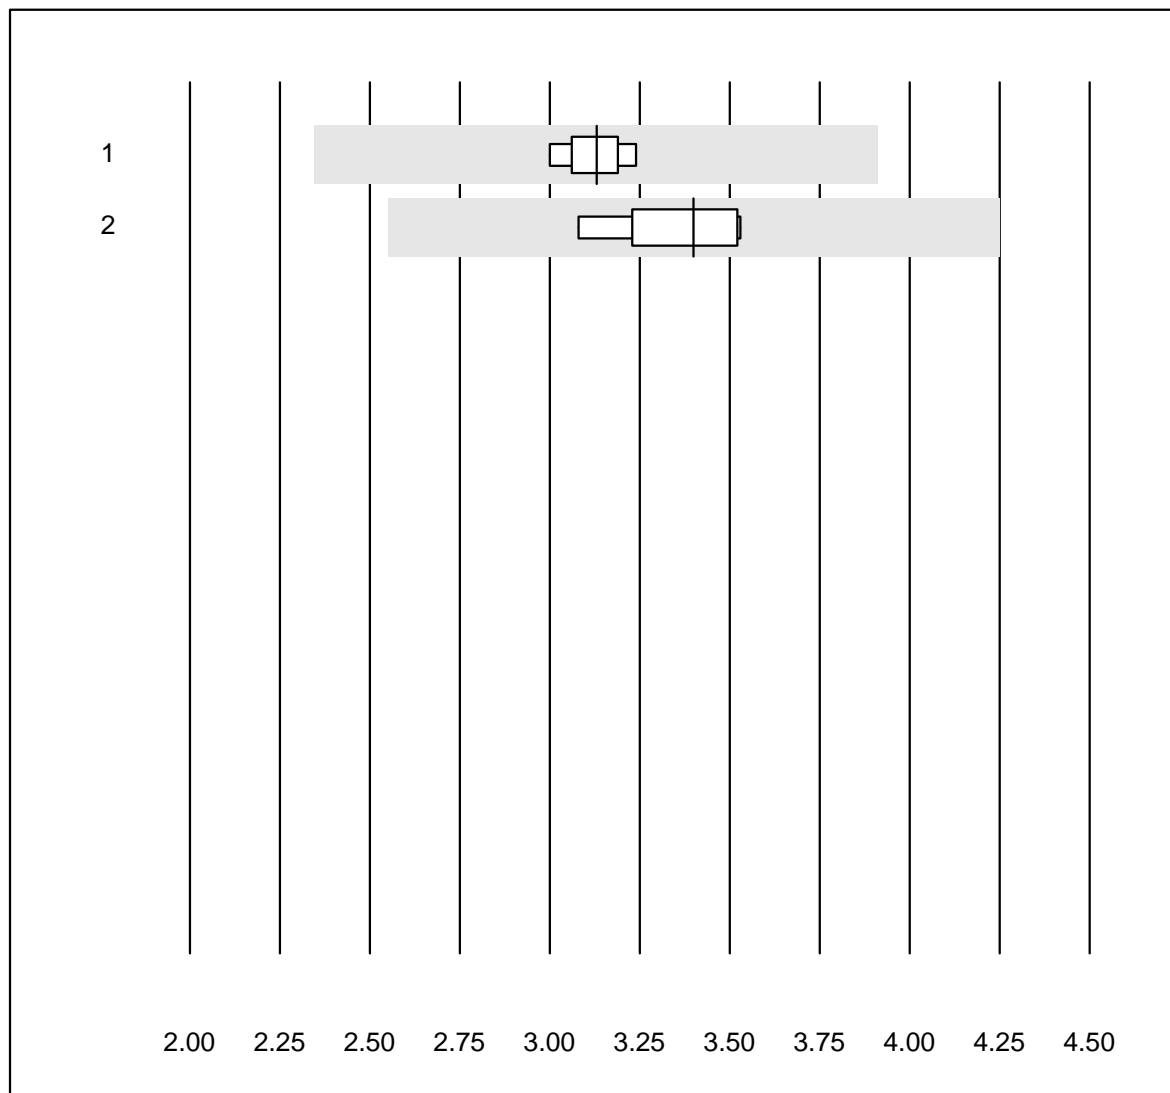


QUALAB Tolérance : 25 %

PSA frei (µg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	9	100.0	0.0	0.0	3.13	2.5	e
2 Architect	5	100.0	0.0	0.0	3.40	5.8	e

CEA

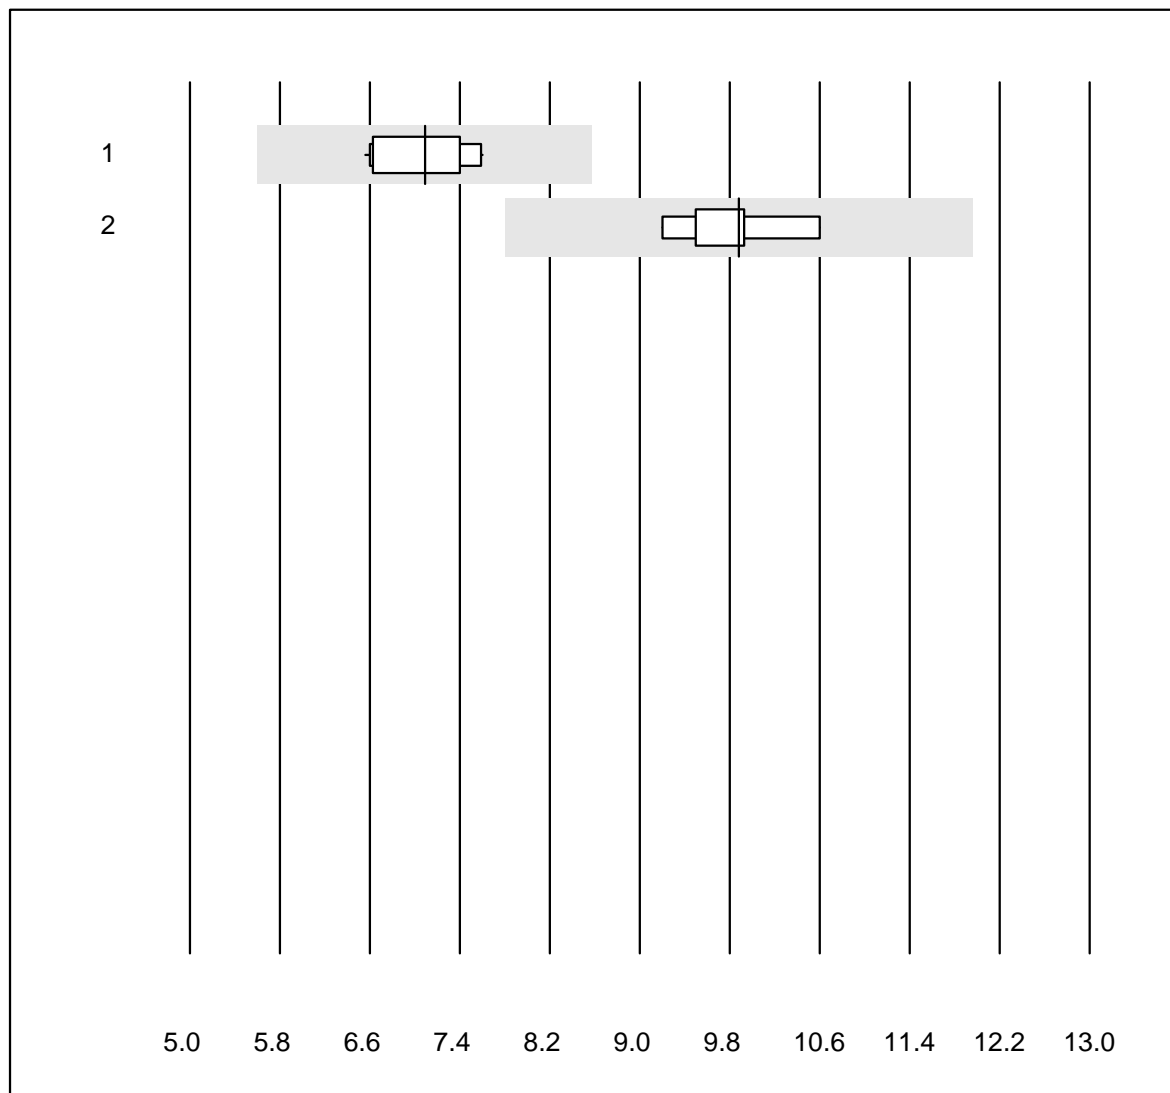


QUALAB Tolérance : 21 %

CEA (µg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	12	100.0	0.0	0.0	7.1	5.6	e
2 Architect	6	100.0	0.0	0.0	9.9	4.8	e

CA 125

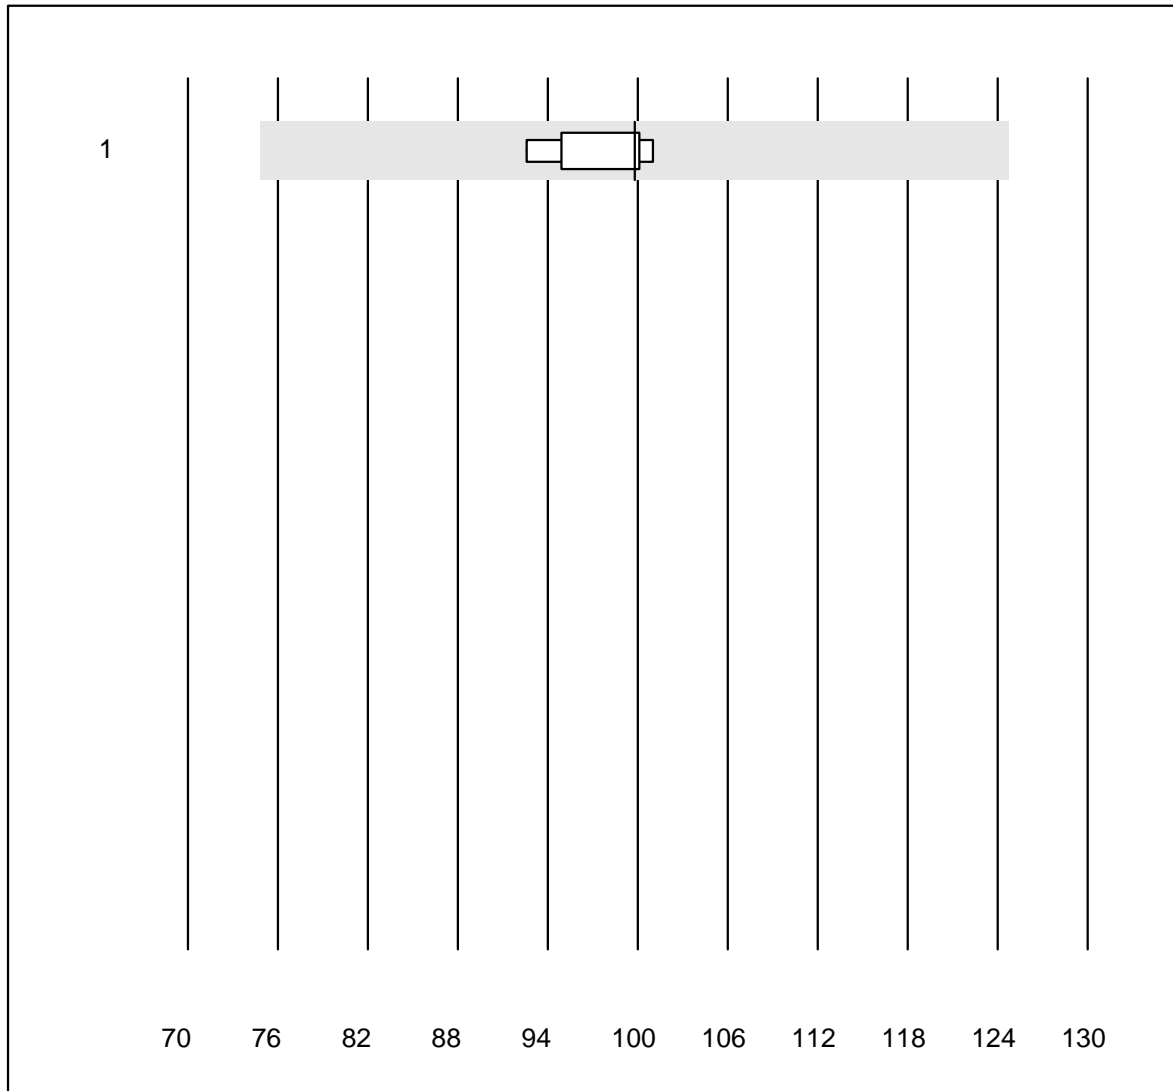


Tolérance MQ : 25 %

CA 125 (kIU/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	7	100.0	0.0	0.0	99.8	3.2	e

CA 19-9

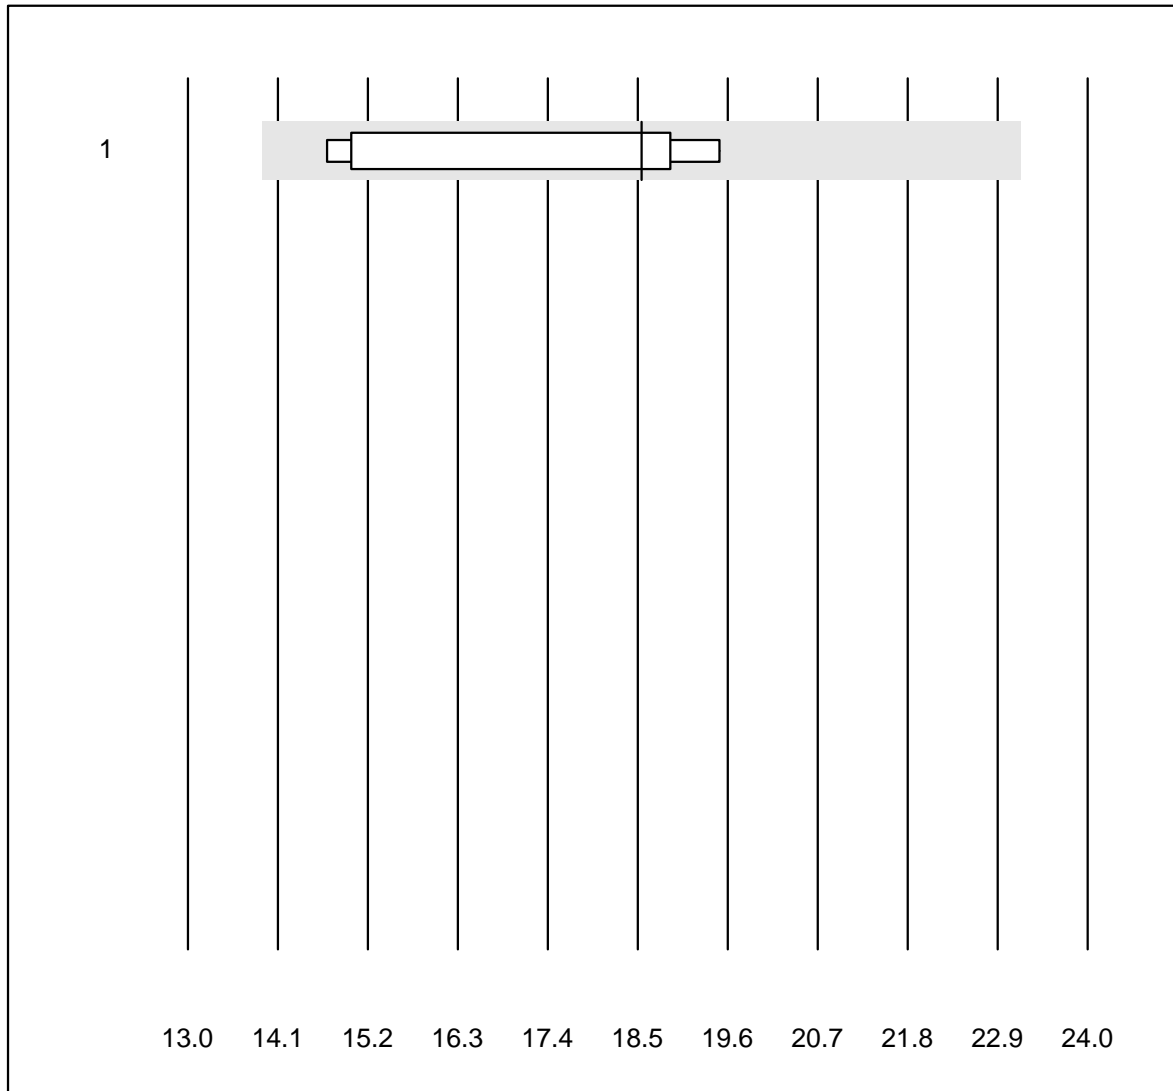


Tolérance MQ : 25 %

CA 19-9 (kIU/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	6	100.0	0.0	0.0	18.6	12.0	e*

CA 15-3

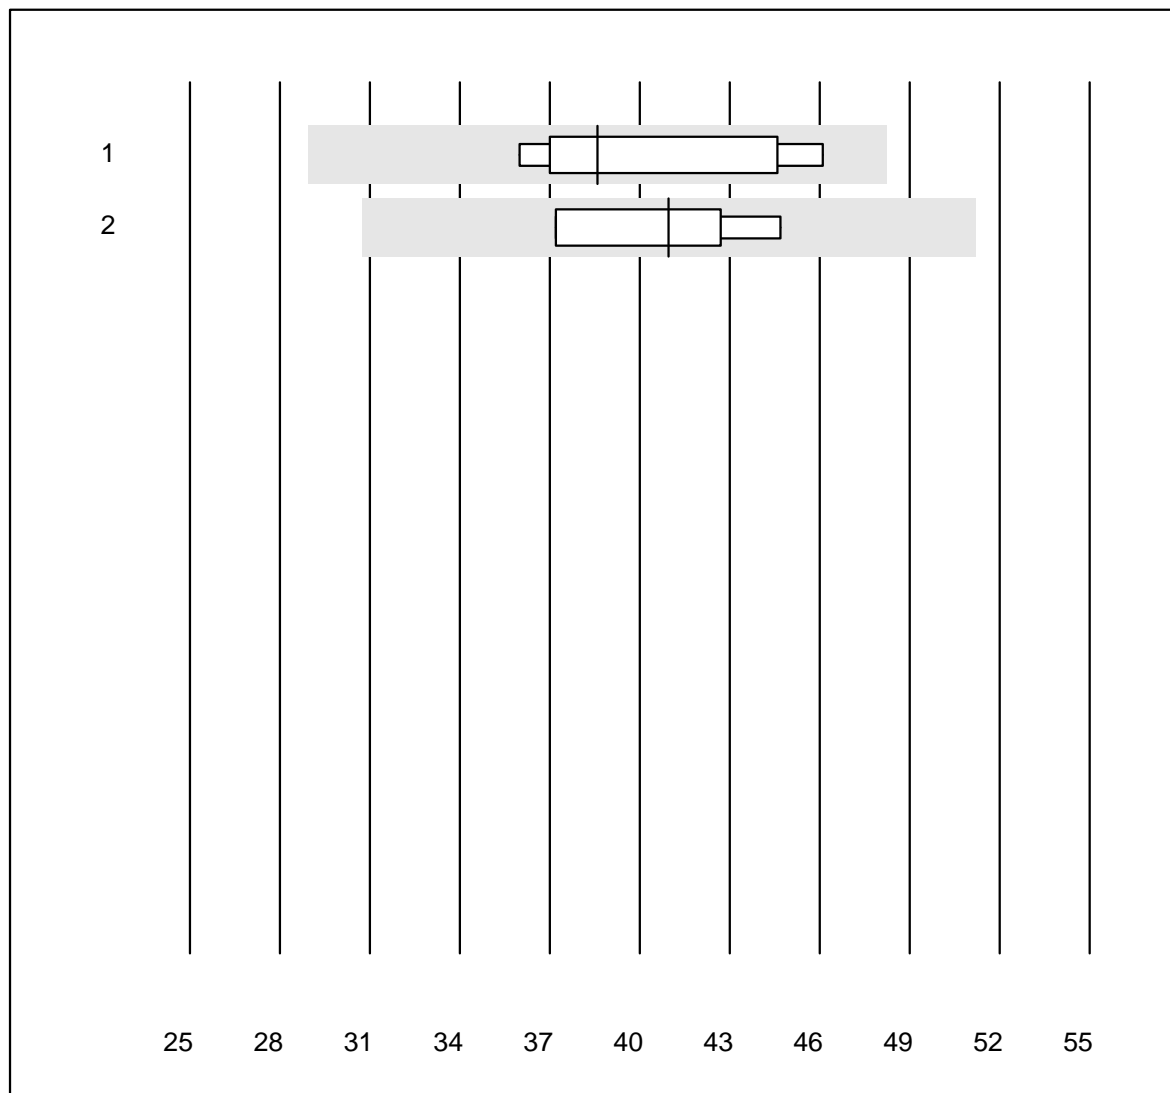


Tolérance MQ : 25 %

CA 15-3 (kIU/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	9	100.0	0.0	0.0	38.6	10.1	e*
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	41.0	8.3	e*

AFP

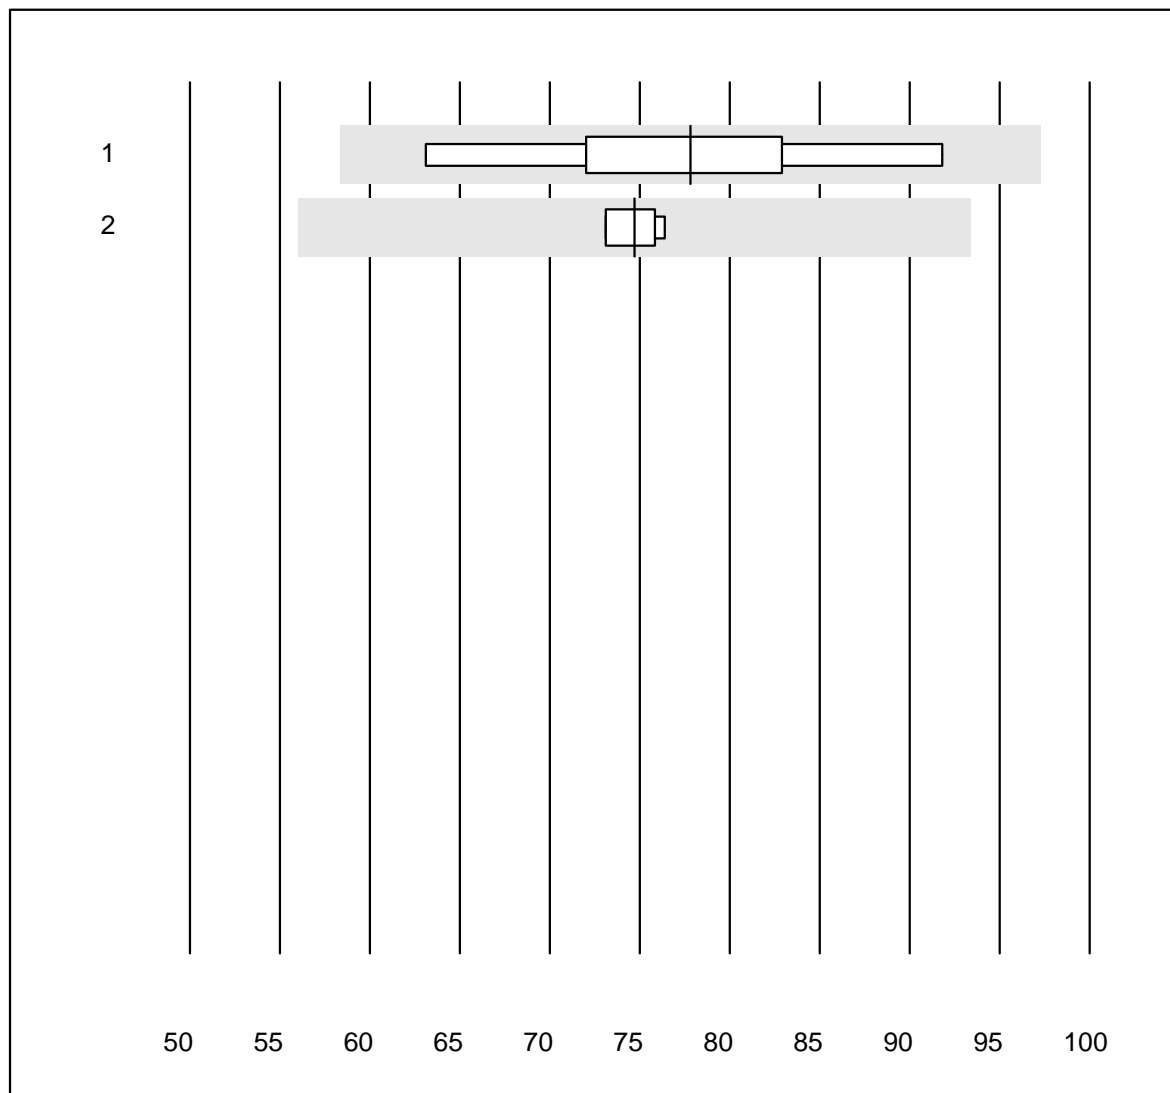


QUALAB Tolérance : 25 %

AFP (µg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	7	100.0	0.0	0.0	77.8	11.8	e*
2 Architect	4	100.0	0.0	0.0	74.7	2.2	e

HCG qn

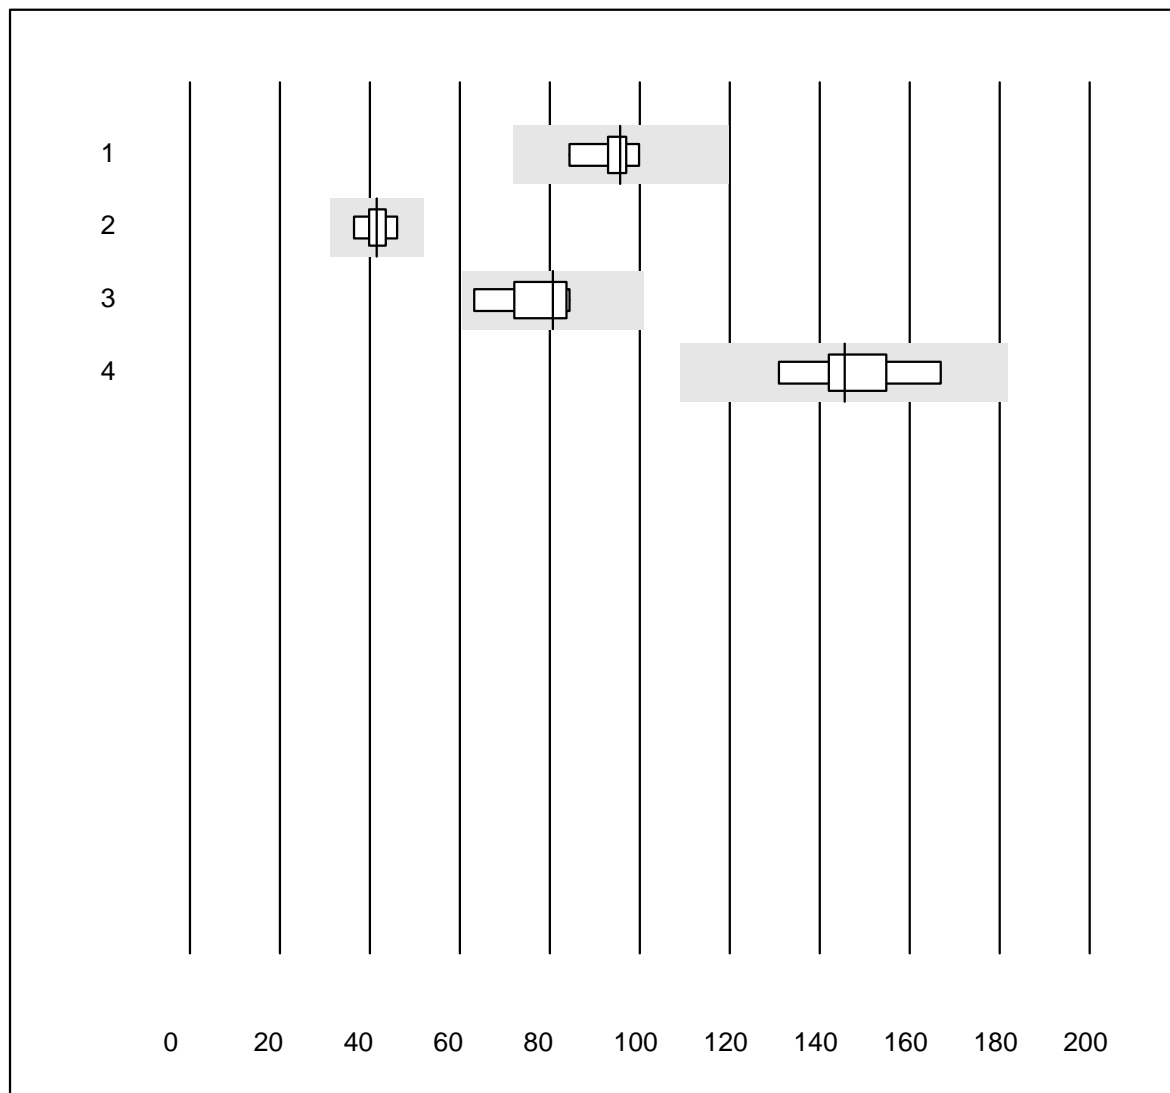


QUALAB Tolérance : 25 %

HCG qn (U/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas E / Elecsys	8	100.0	0.0	0.0	95.7	4.9	e
2 VIDAS	8	100.0	0.0	0.0	41.5	7.3	e
3 Architect	6	100.0	0.0	0.0	80.6	10.9	e*
4 AFIAS	9	88.9	0.0	11.1	145.5	7.9	e

HCG intakt

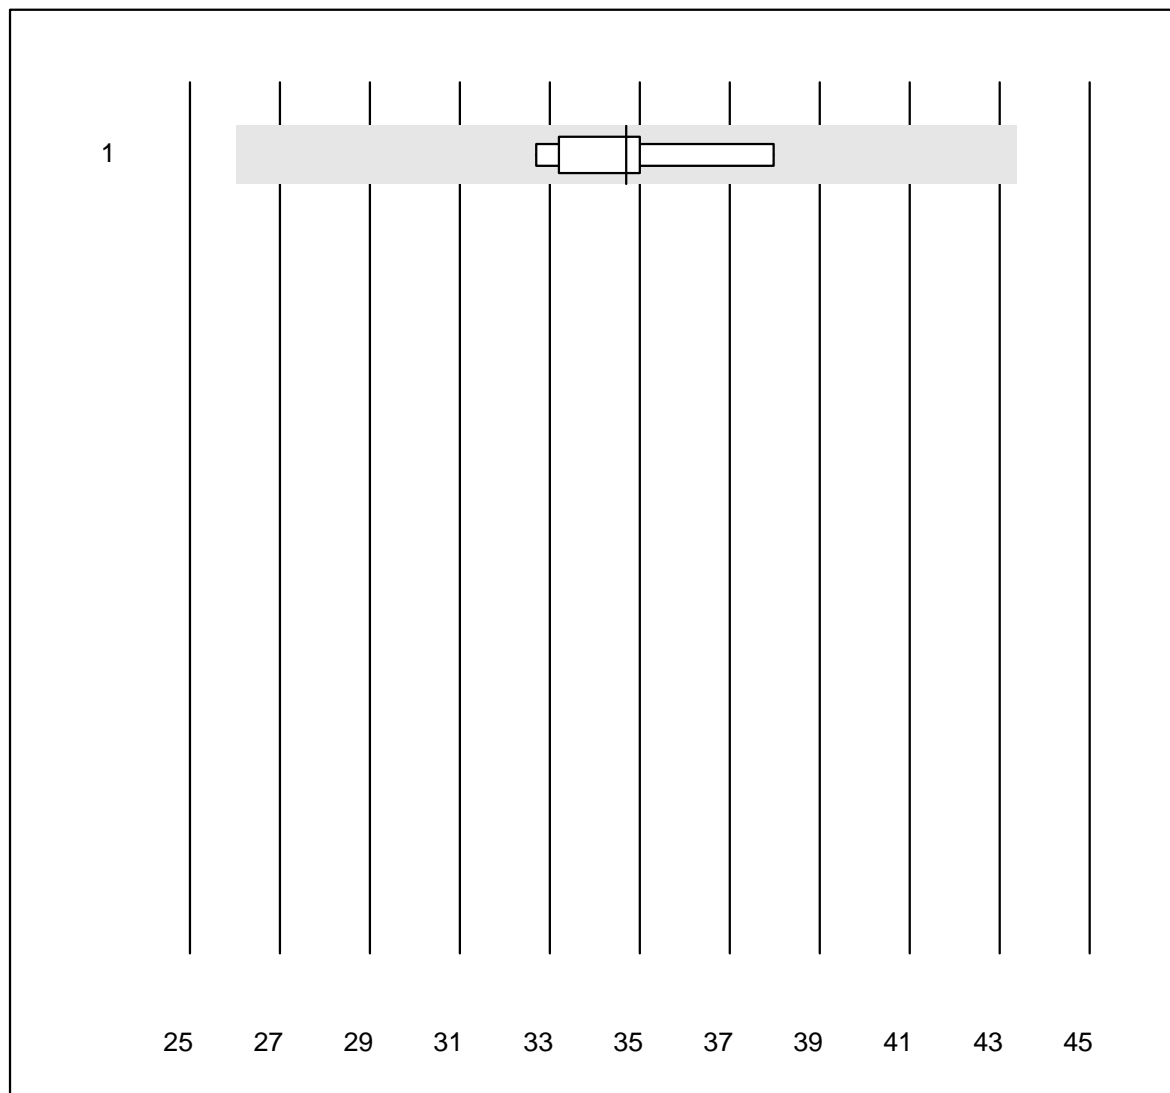


QUALAB Tolérance : 25 %

HCG intakt (U/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	34.7	6.0	e

S100

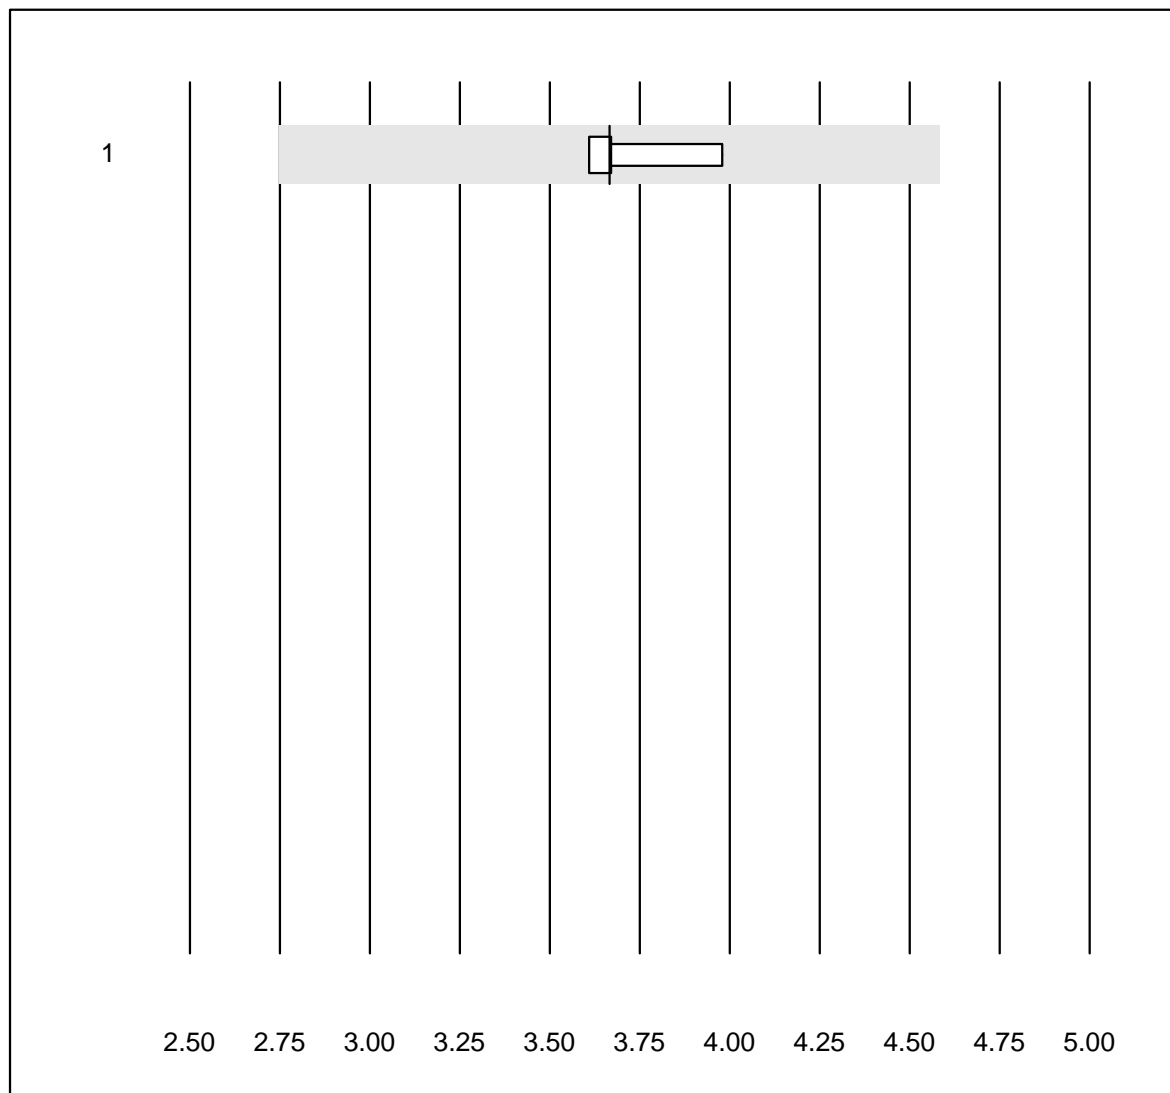


Tolérance MQ : 25 %

S100 (µg/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	3.67	4.5	e

NSE

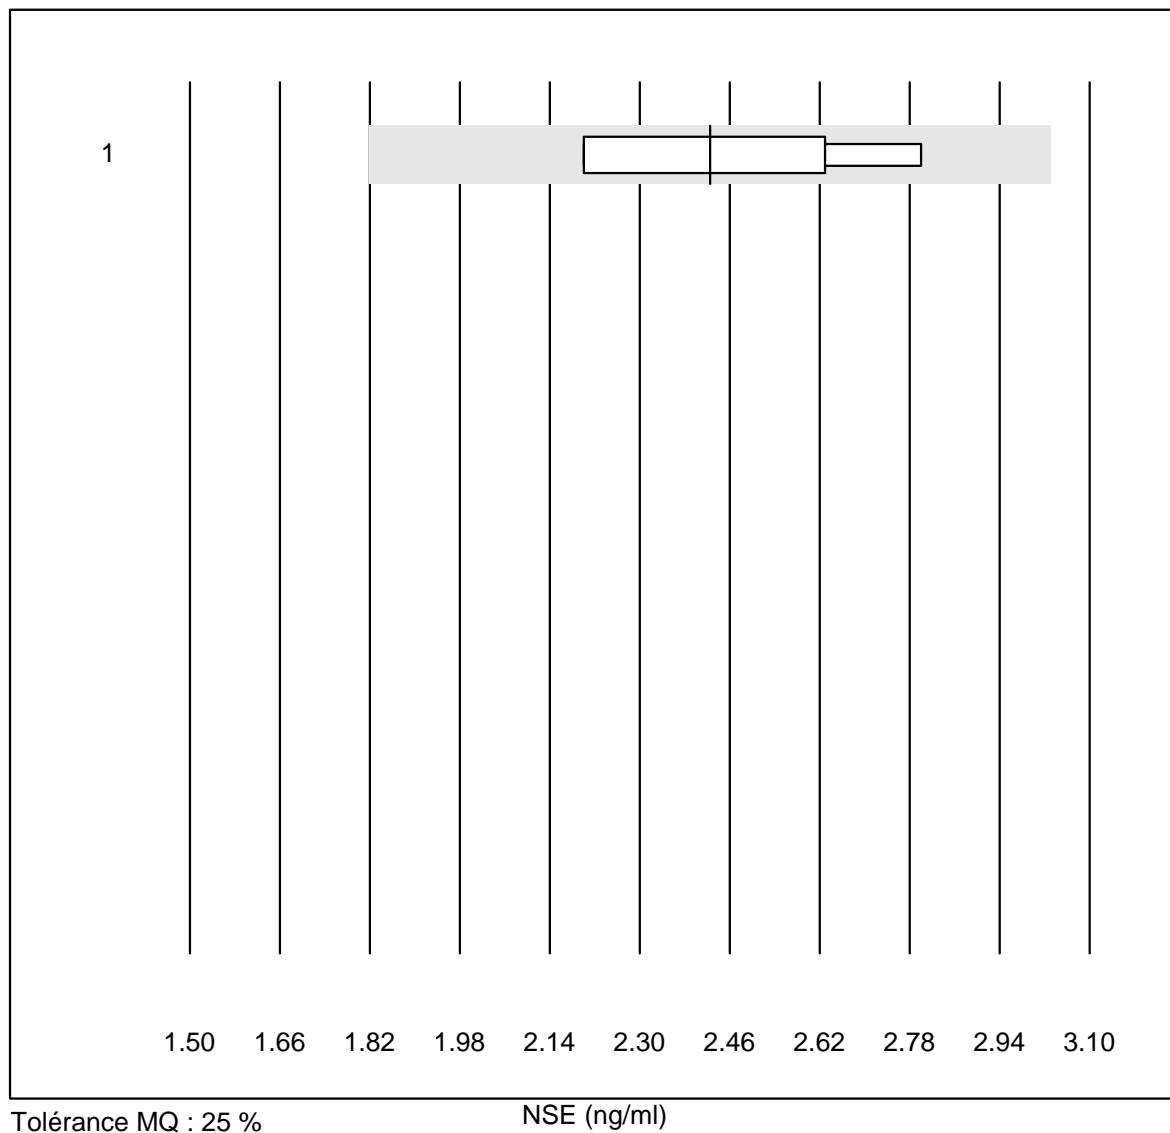

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	2.4	12.2	e*

Thyreoglobuline

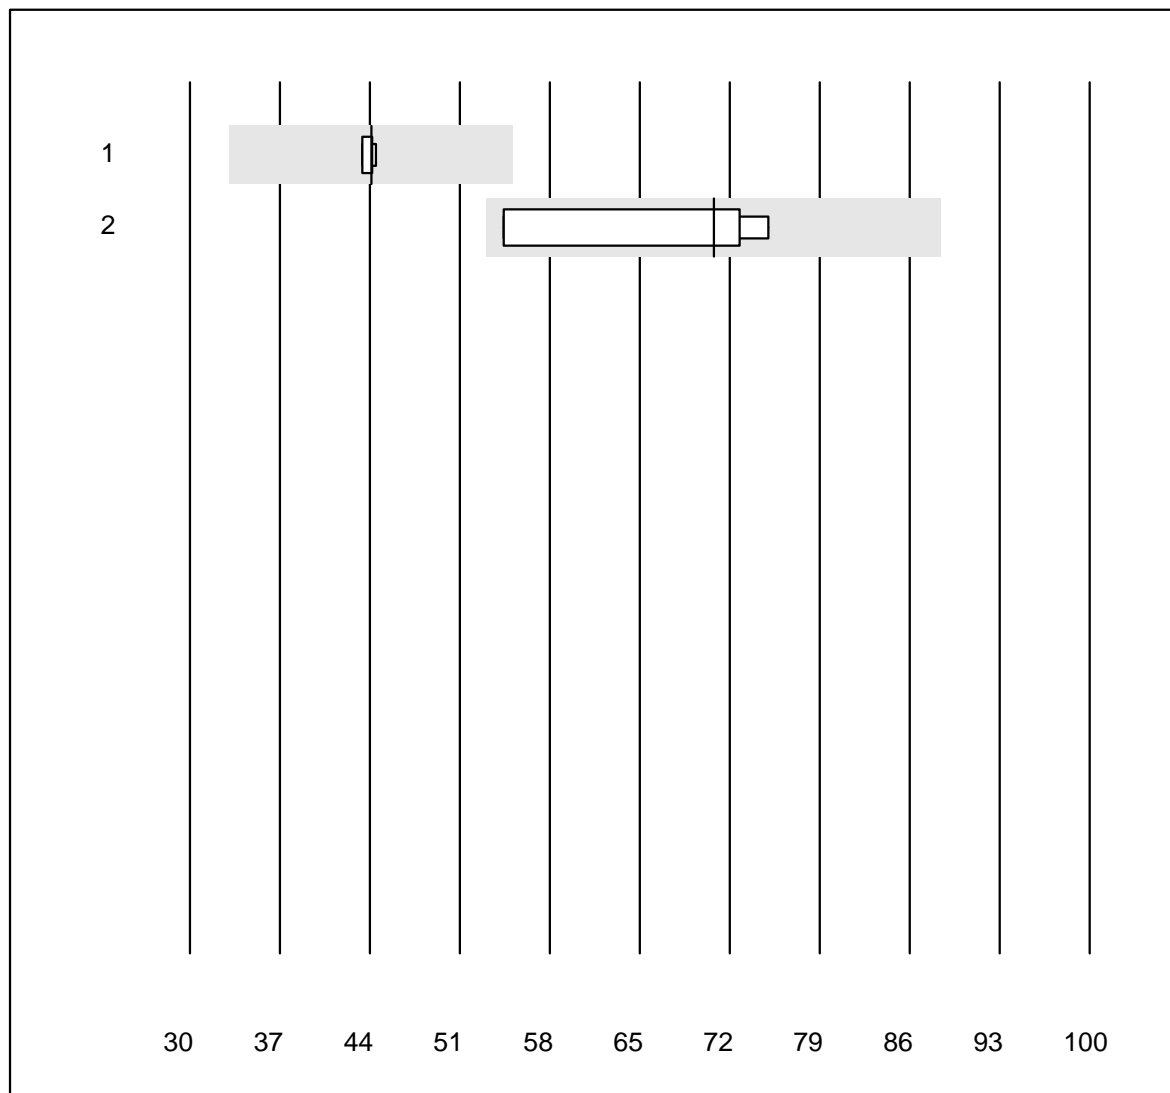


Tolérance MQ : 25 %

Thyreoglobuline (µg/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	44.1	1.0	e
2 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	70.8	13.6	e*

CK-MB

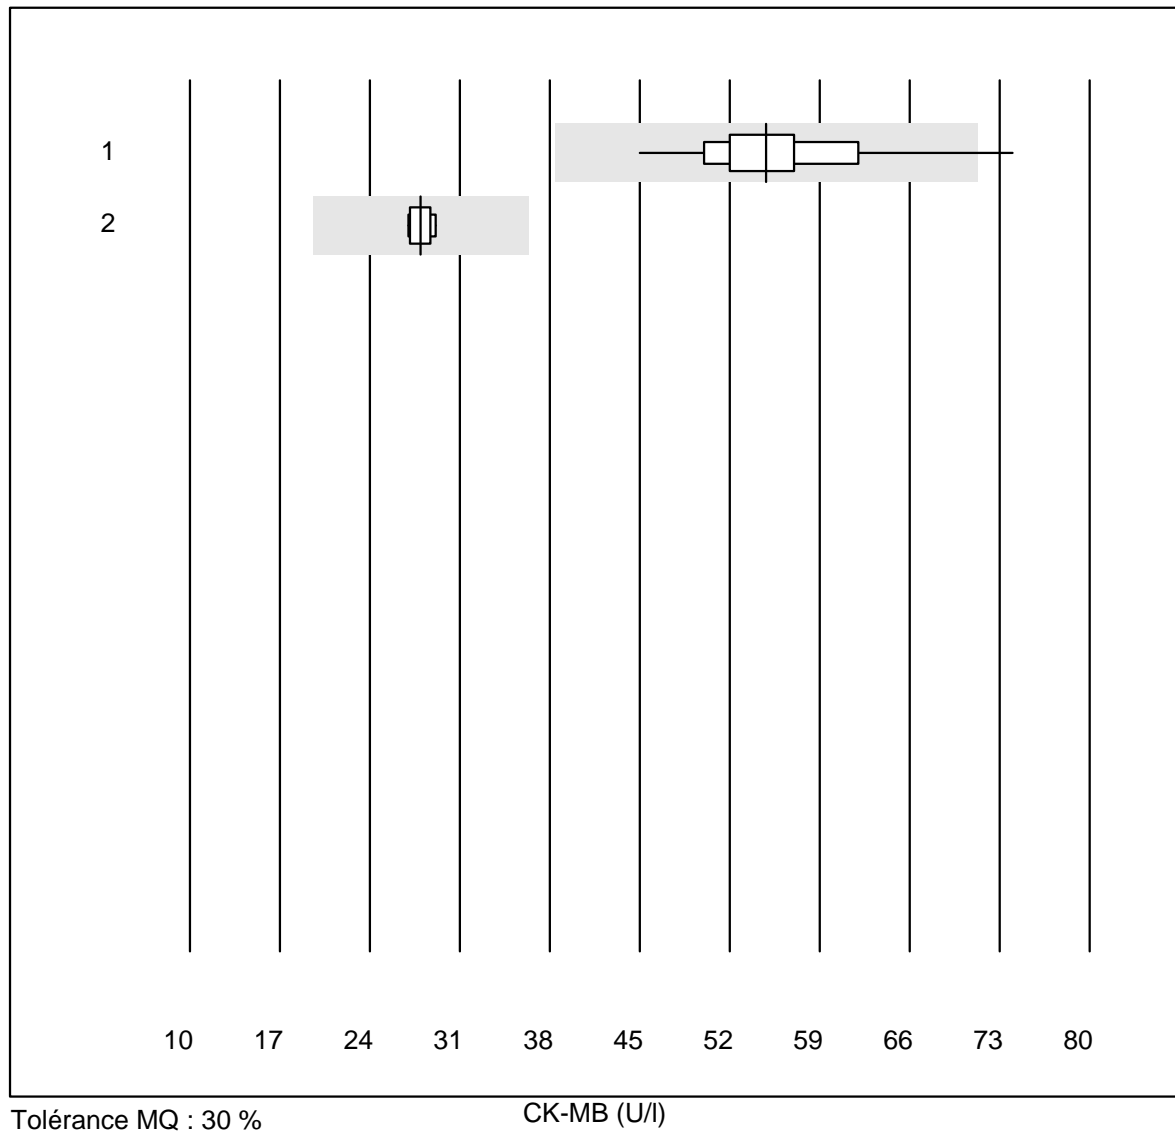

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Fuji Dri-Chem	33	90.9	6.1	3.0	54.8	11.1	e
2 Cobas/Roche	6	100.0	0.0	0.0	28.0	3.0	e

Cholestérol PTS

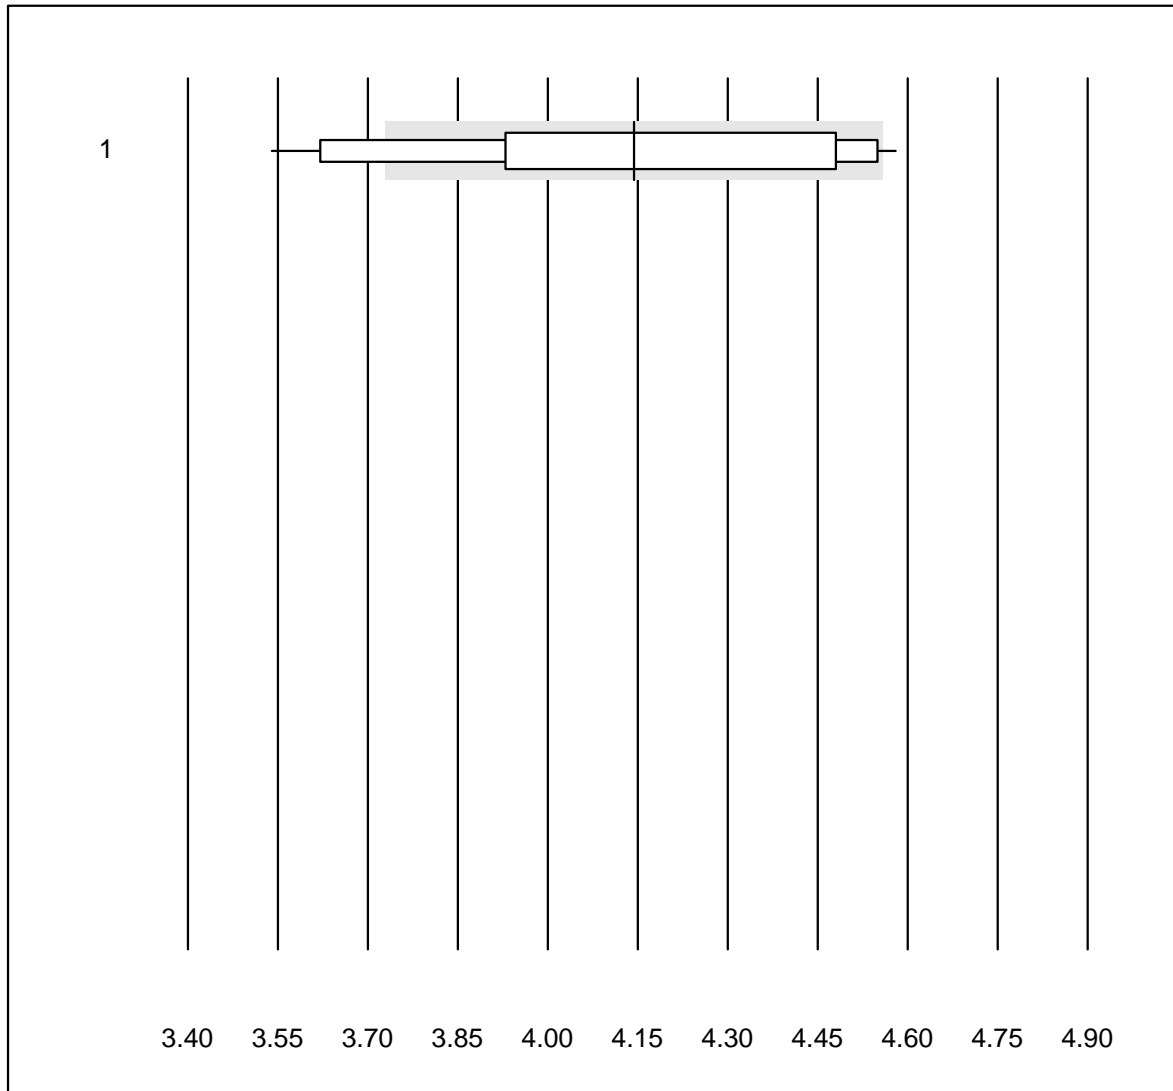


QUALAB Tolérance : 10 %

Cholestérol PTS (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 CardioChek	18	77.7	16.7	5.6	4.14	8.2	e*

Cholestérol HDL PTS

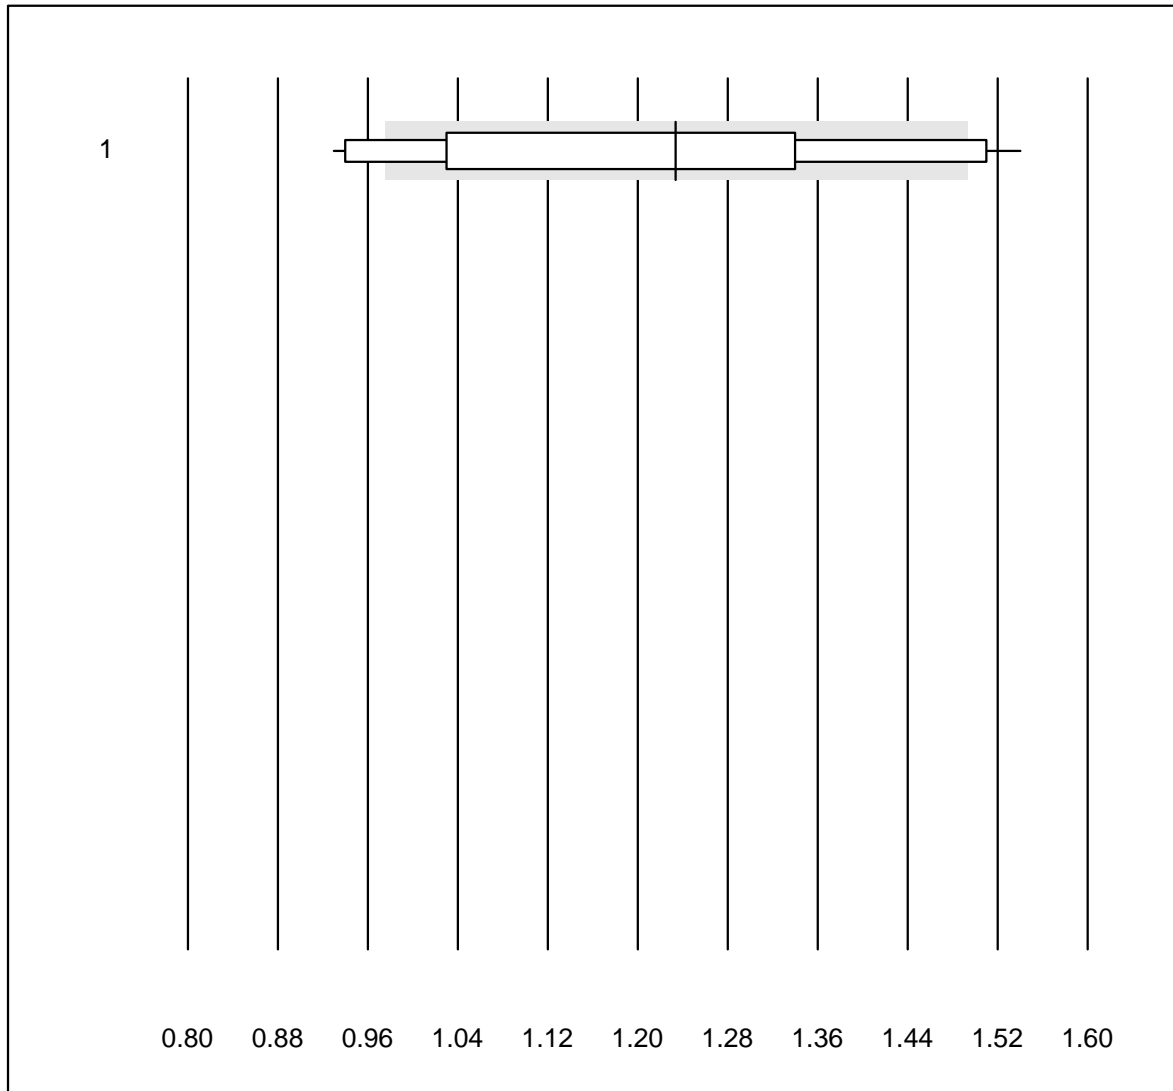


QUALAB Tolérance : 21 %

Cholestérol HDL PTS (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 CardioChek	18	61.1	27.8	11.1	1.23	16.7	e*

Triglycérides PTS

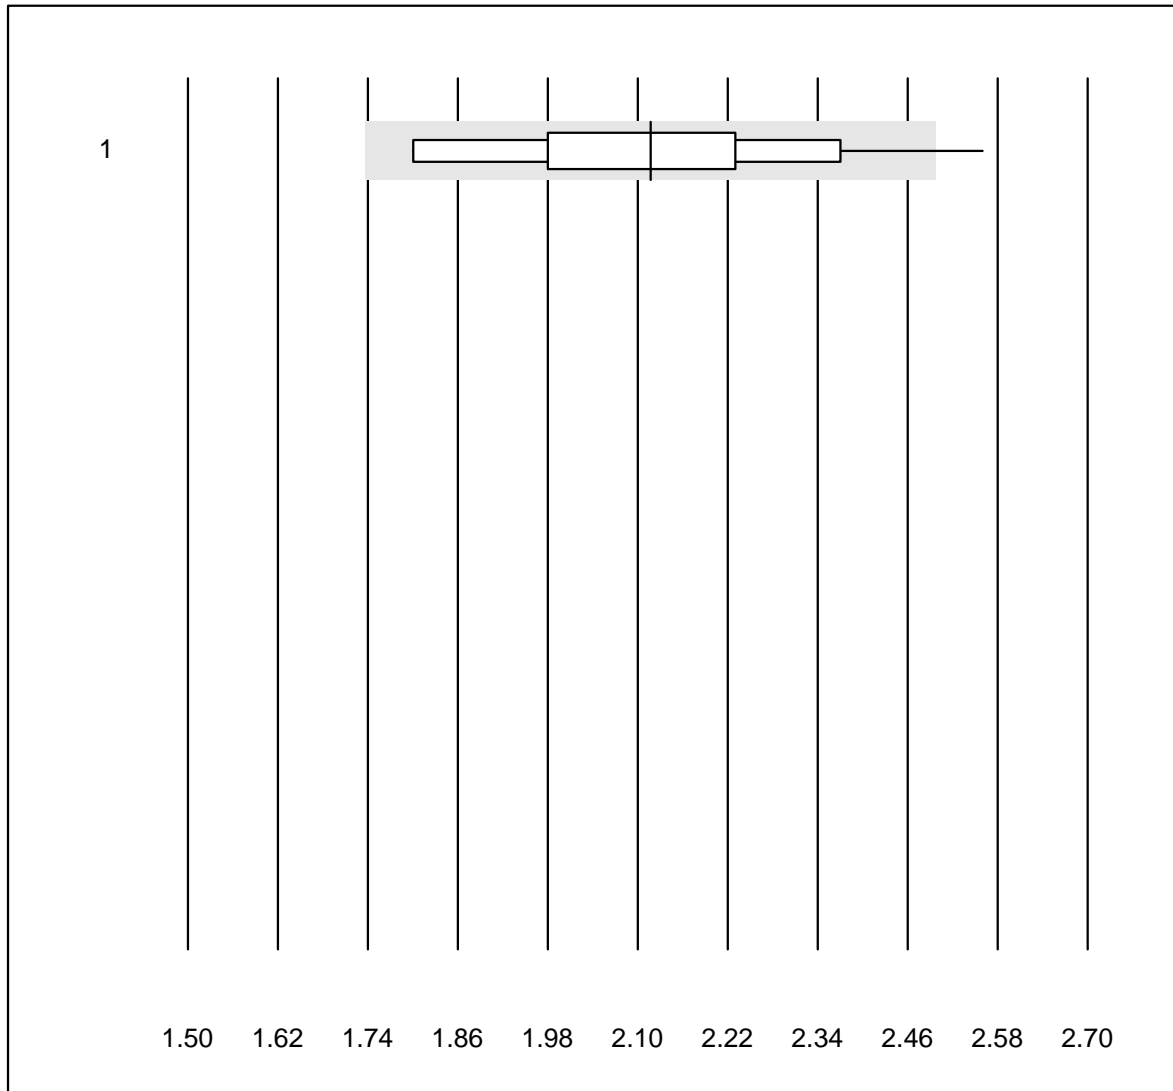


QUALAB Tolérance : 18 %

Triglycérides PTS (mmol/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 CardioChek	18	94.4	5.6	0.0	2.12	10.0	e*

C-Peptid

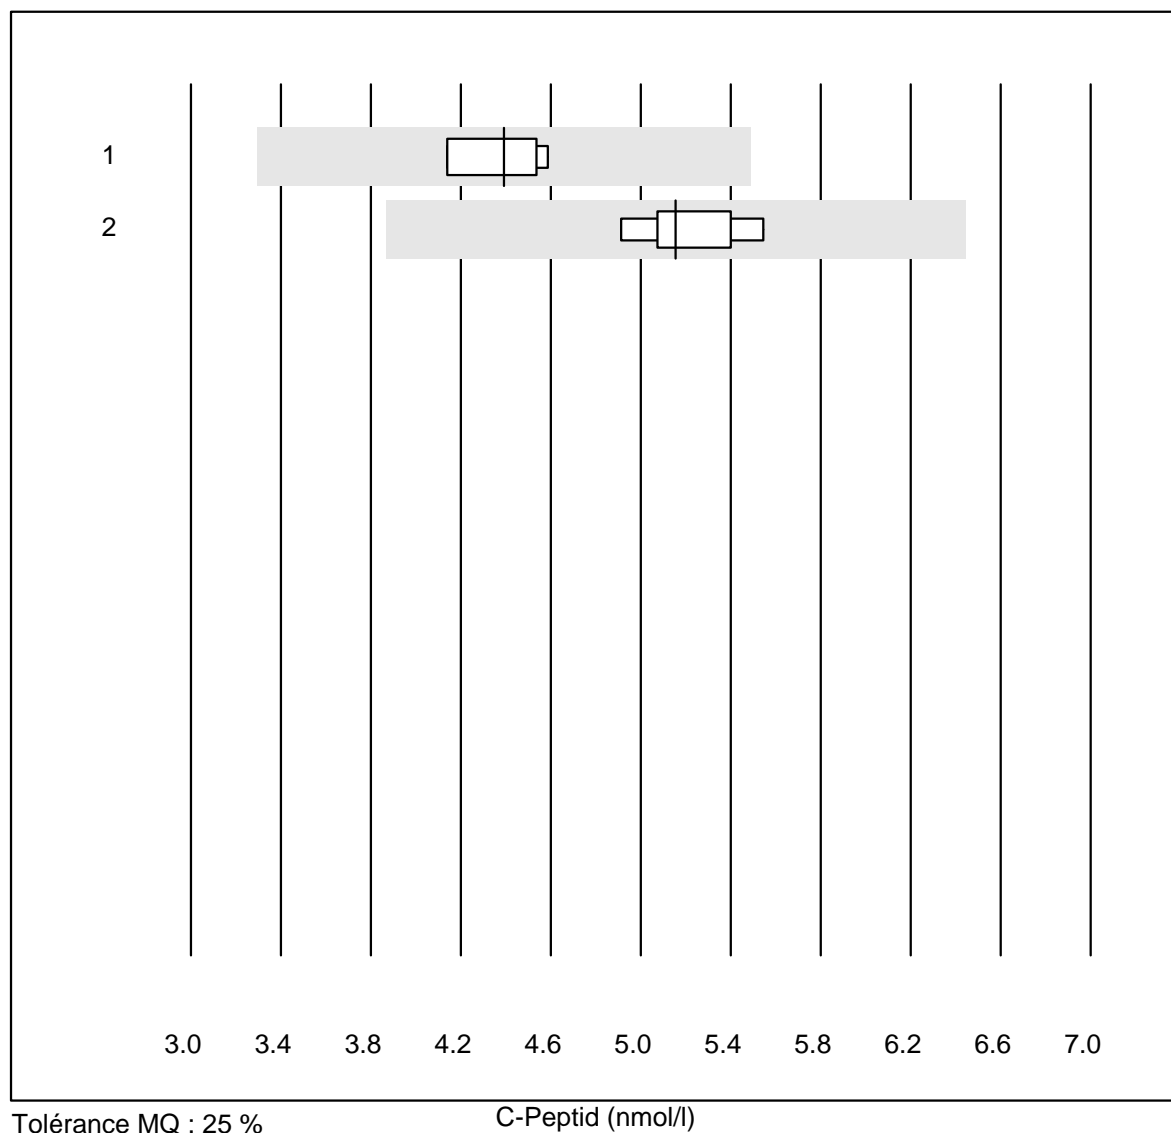


No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	4.39	5.0	e
2 Liaison	6	100.0	0.0	0.0	5.16	4.4	e

ACTH

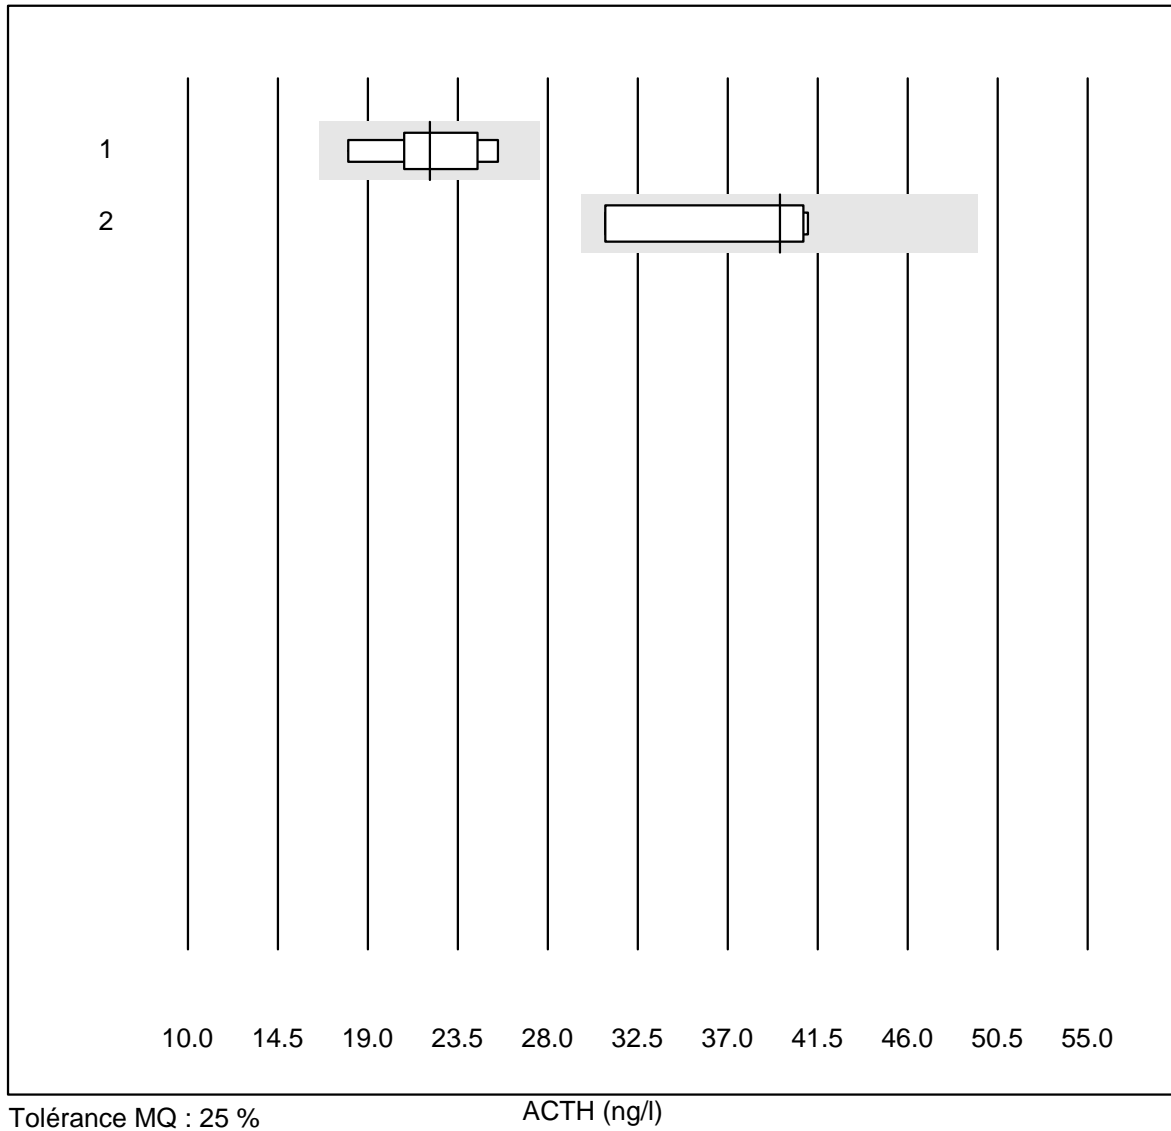

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	7	100.0	0.0	0.0	22.10	11.1	e*
2 Liaison	4	100.0	0.0	0.0	39.60	12.6	e*

Procalcitonine

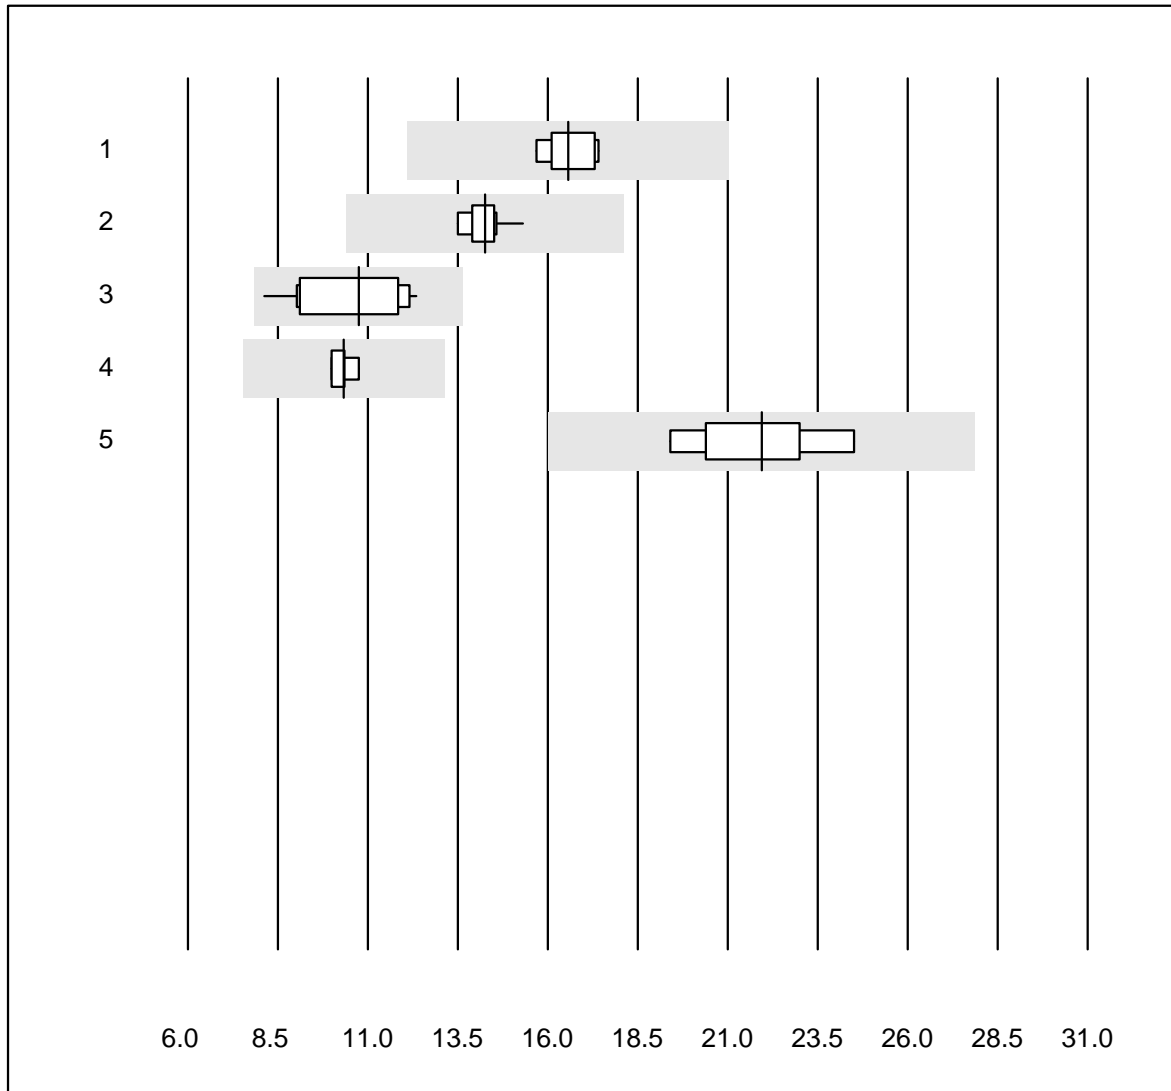


QUALAB Tolérance : 27 %

Procalcitonine (µg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Architect	6	100.0	0.0	0.0	16.56	4.0	e
2 Cobas	10	100.0	0.0	0.0	14.25	3.5	e
3 VIDAS	11	100.0	0.0	0.0	10.75	13.3	e*
4 Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	10.33	2.9	e
5 Liaison	6	83.3	0.0	16.7	21.95	9.6	e*

Parathormone

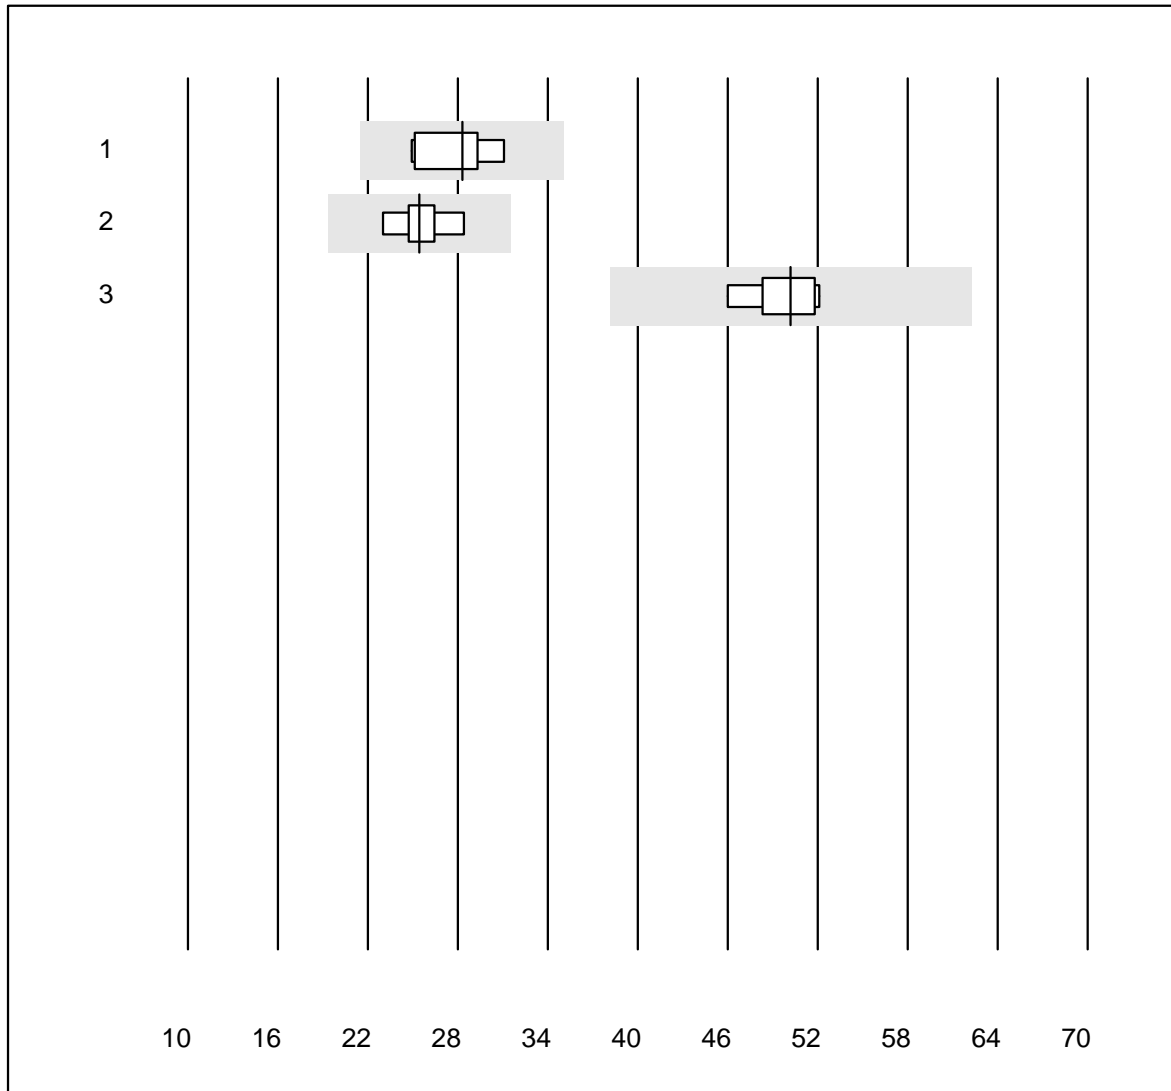


QUALAB Tolérance : 24 %

Parathormone (pmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas PTH STAT	8	100.0	0.0	0.0	28.3	7.9	e
2 Cobas	9	100.0	0.0	0.0	25.4	6.3	e
3 Architect	5	100.0	0.0	0.0	50.2	5.1	e

Osmolalité

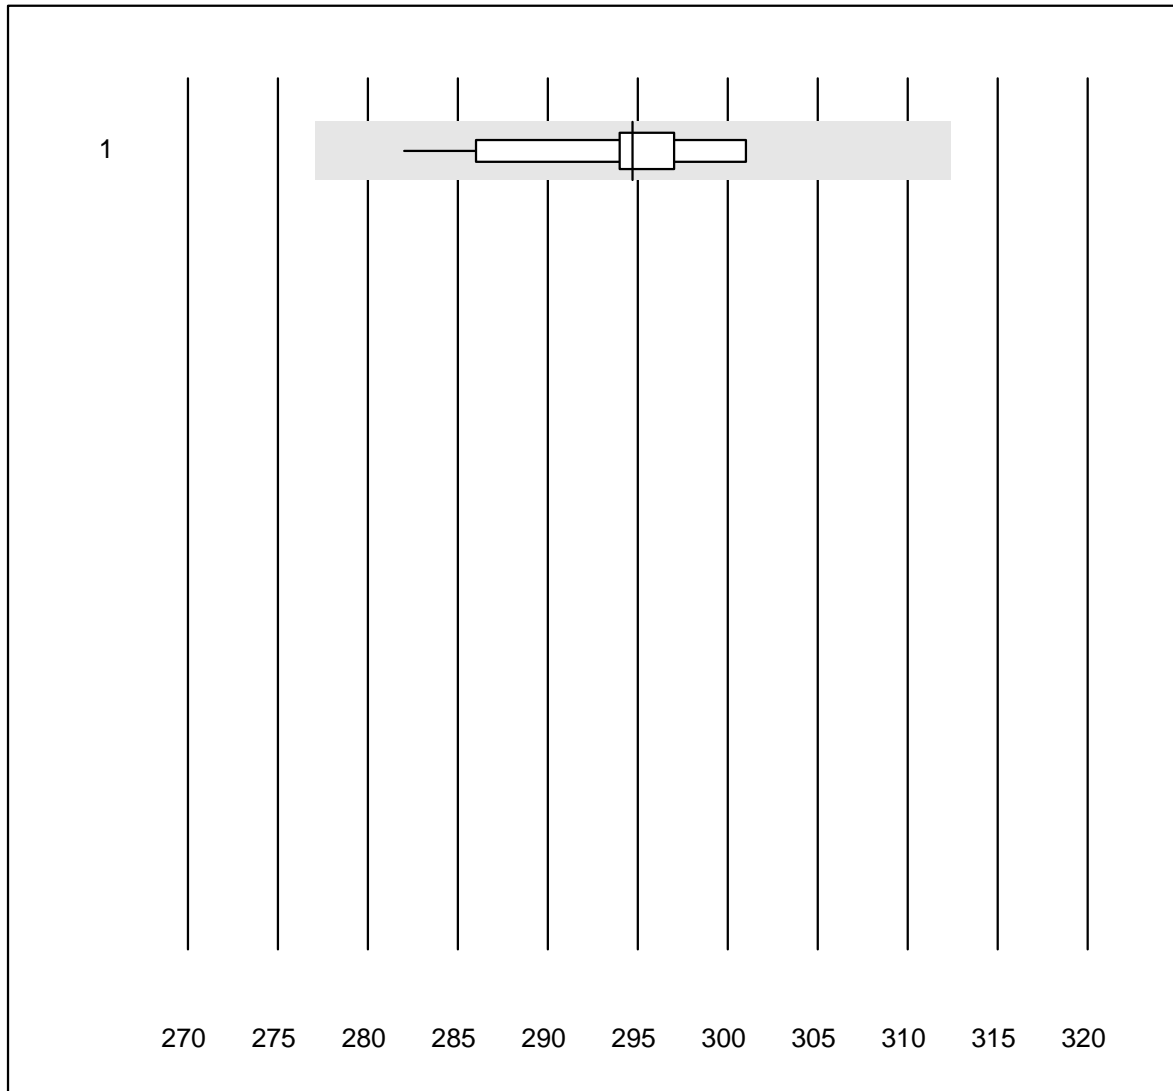


QUALAB Tolérance : 6 %

Osmolalité (mosm/kg)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cryoscopie	18	100.0	0.0	0.0	295	1.6	e

Kalium-K22

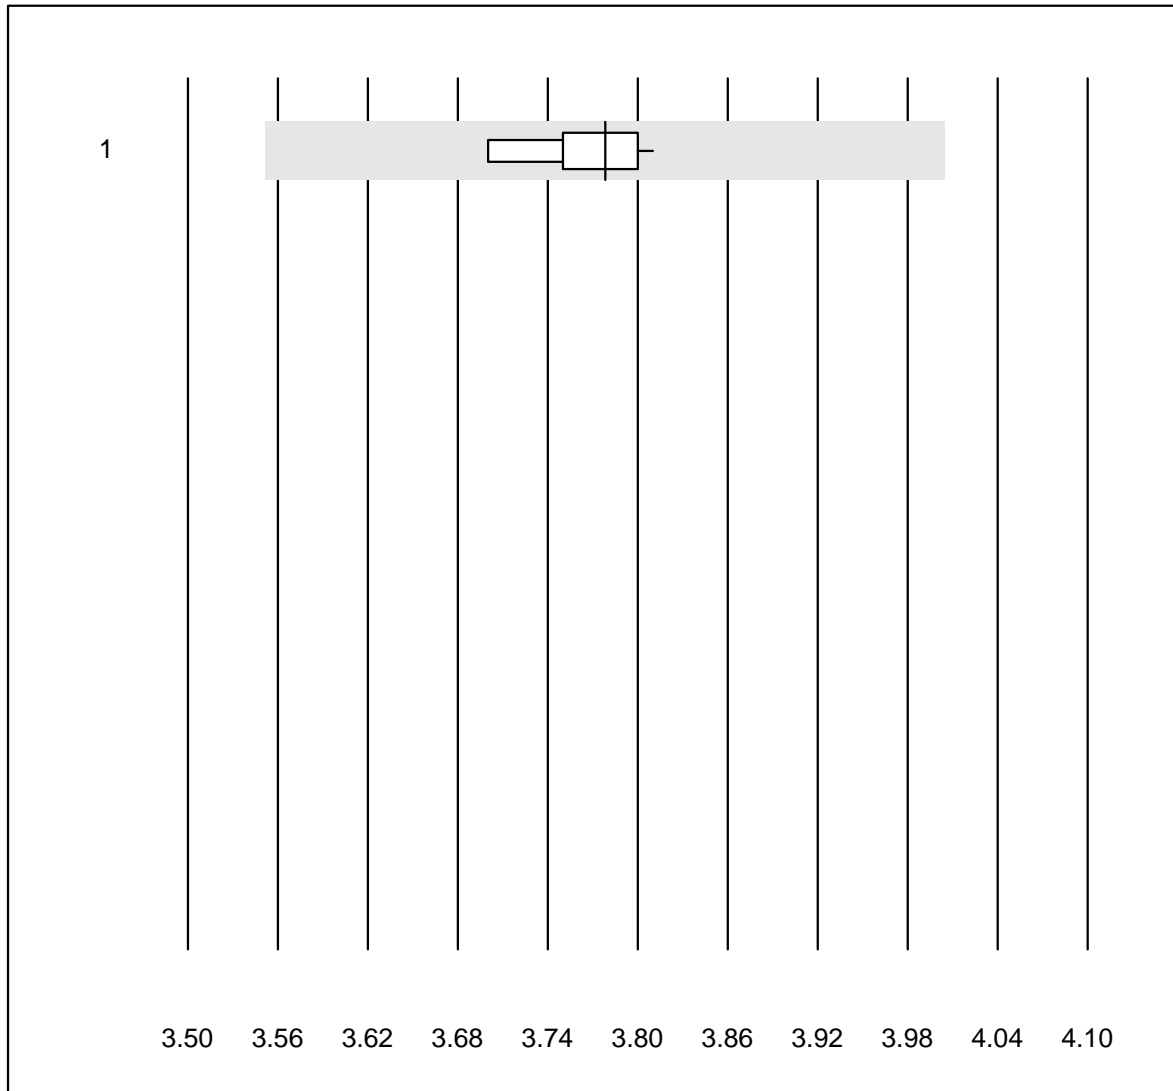


QUALAB Tolérance : 6 %

Kalium-K22 (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 ISE	11	100.0	0.0	0.0	3.8	1.1	e

Natrium-K22

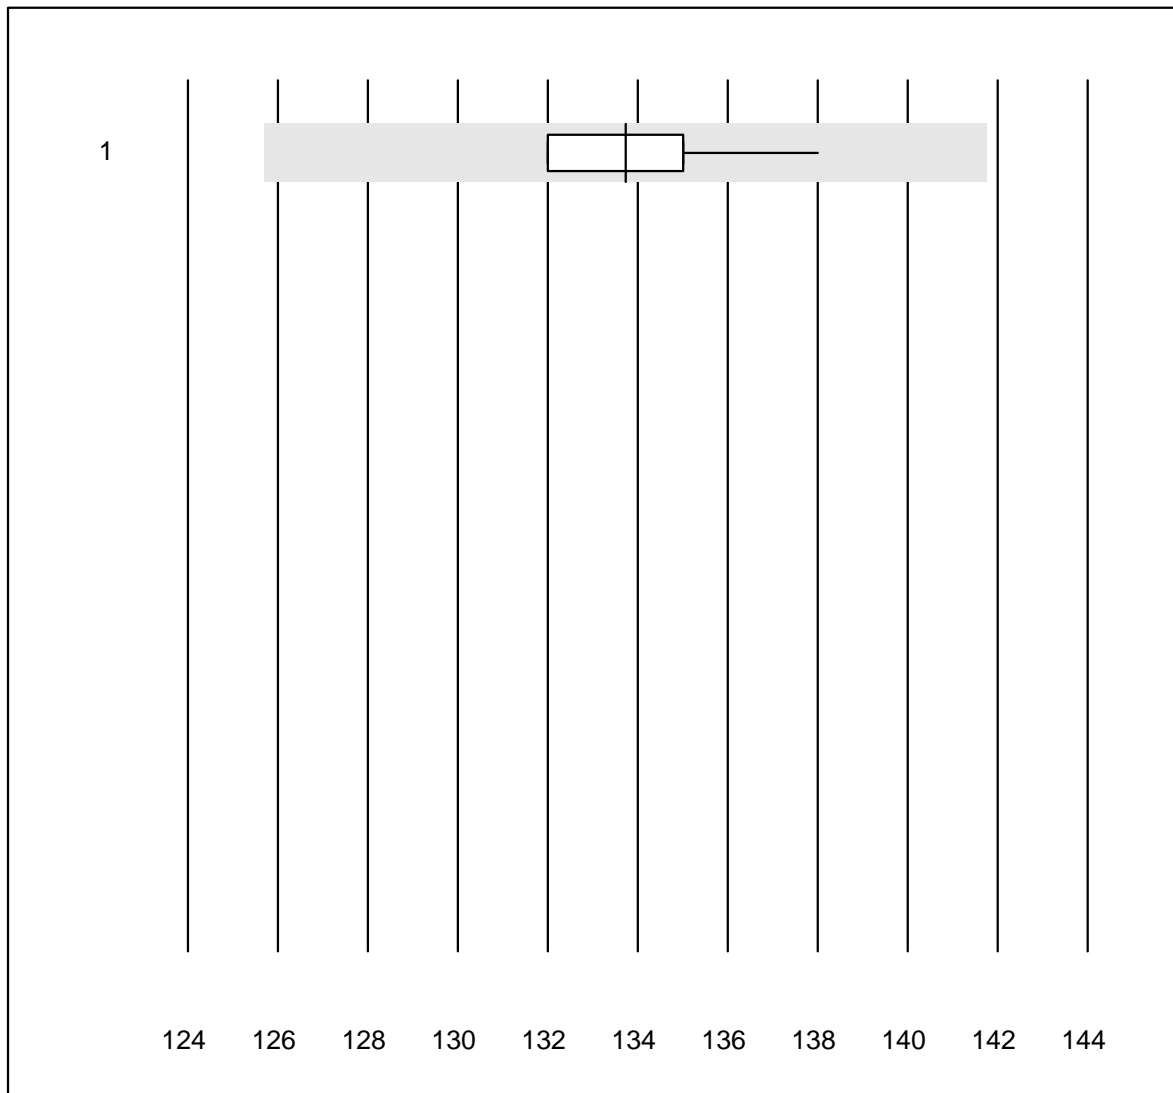


QUALAB Tolérance : 6 %

Natrium-K22 (mmol/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 ISE	11	100.0	0.0	0.0	134	1.3	e

Glukose-K22

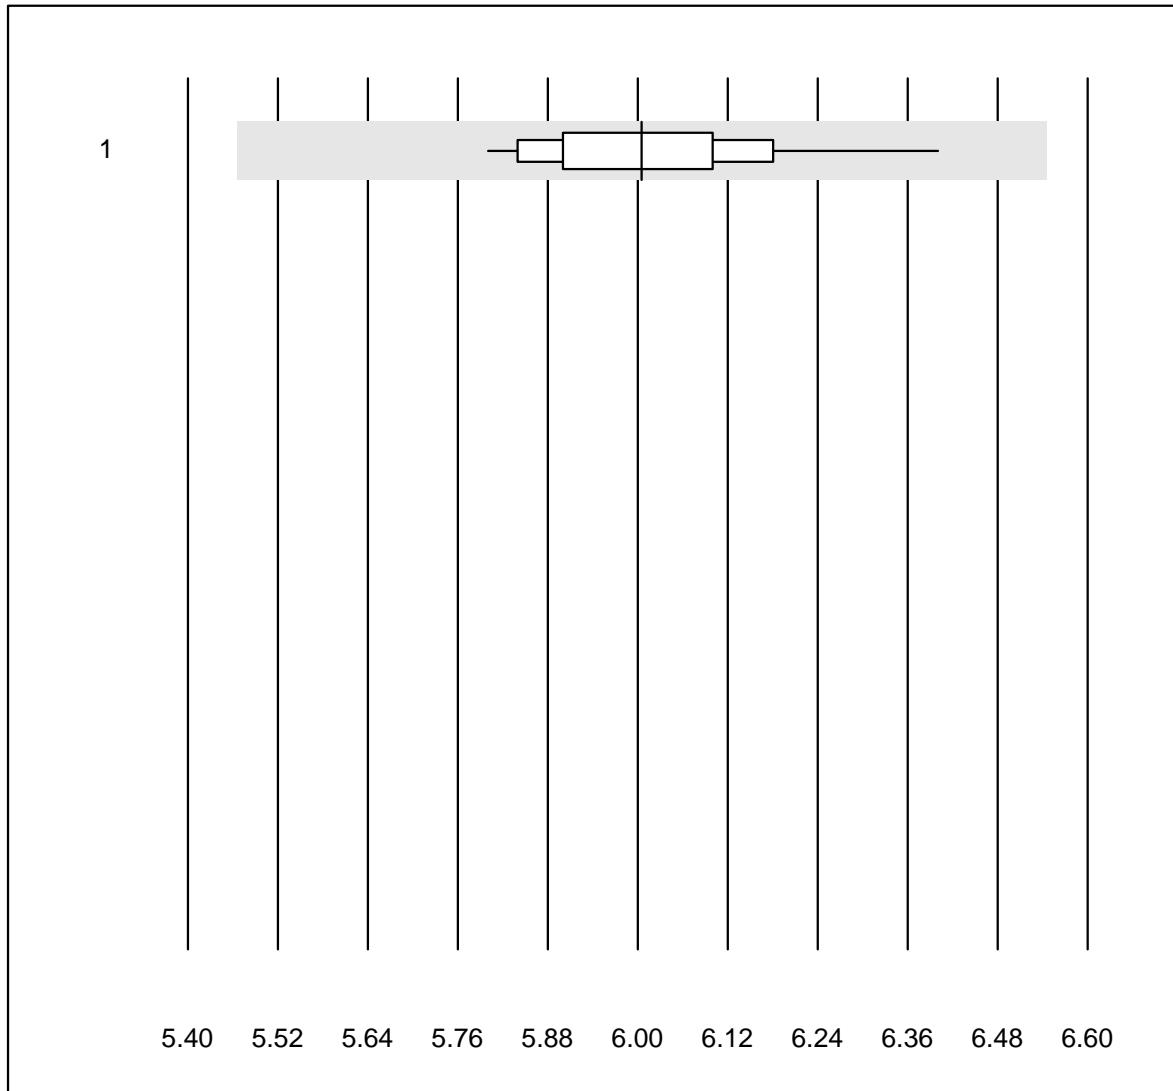


QUALAB Tolérance : 9 %

Glukose-K22 (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	11	100.0	0.0	0.0	6.0	2.8	e

Harnstoff-K22

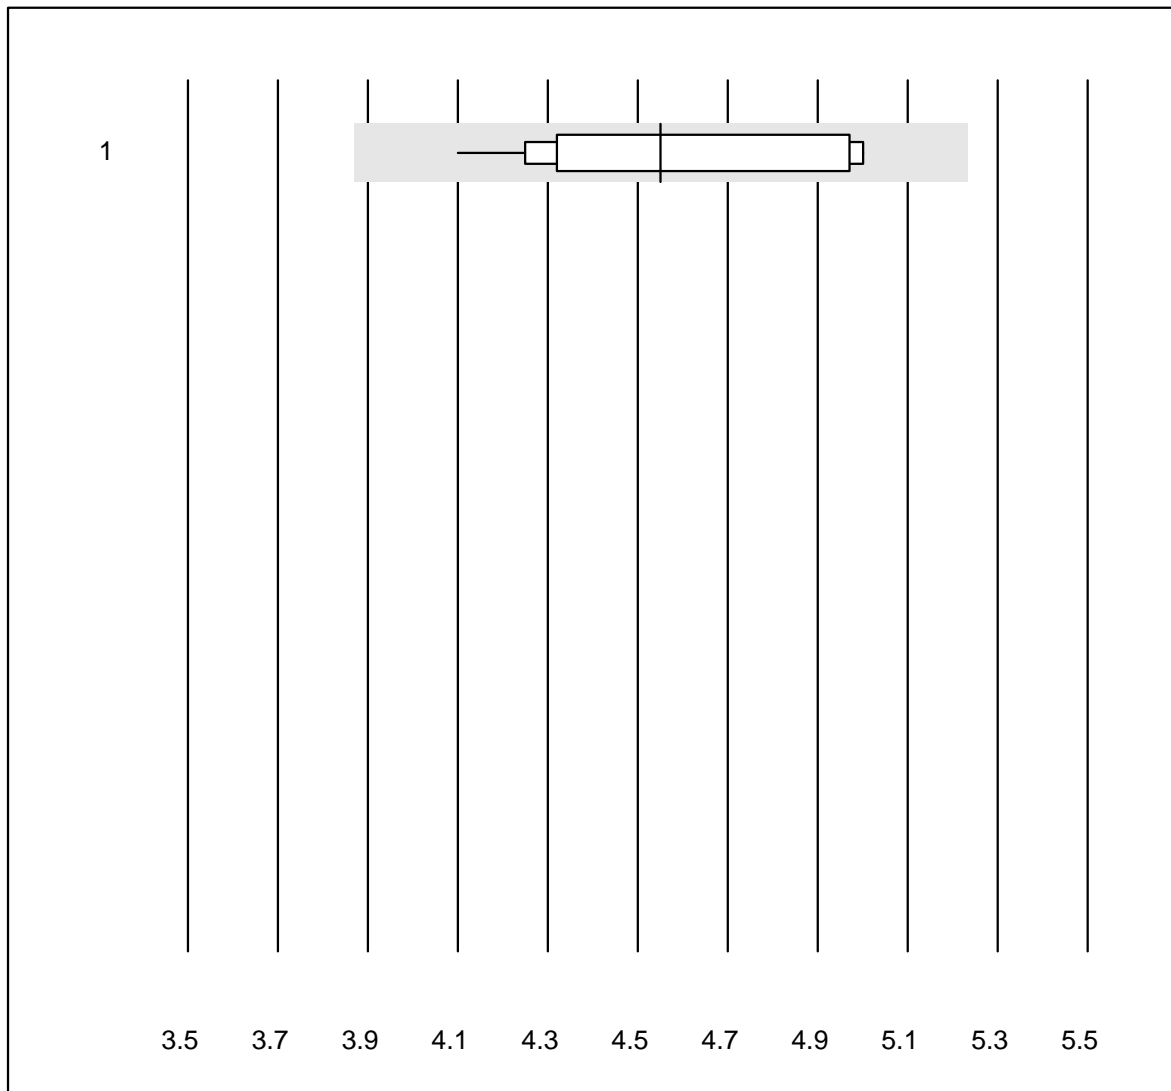


QUALAB Tolérance : 15 %

Harnstoff-K22 (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	11	100.0	0.0	0.0	4.6	7.5	e*

Osmotische Lücke

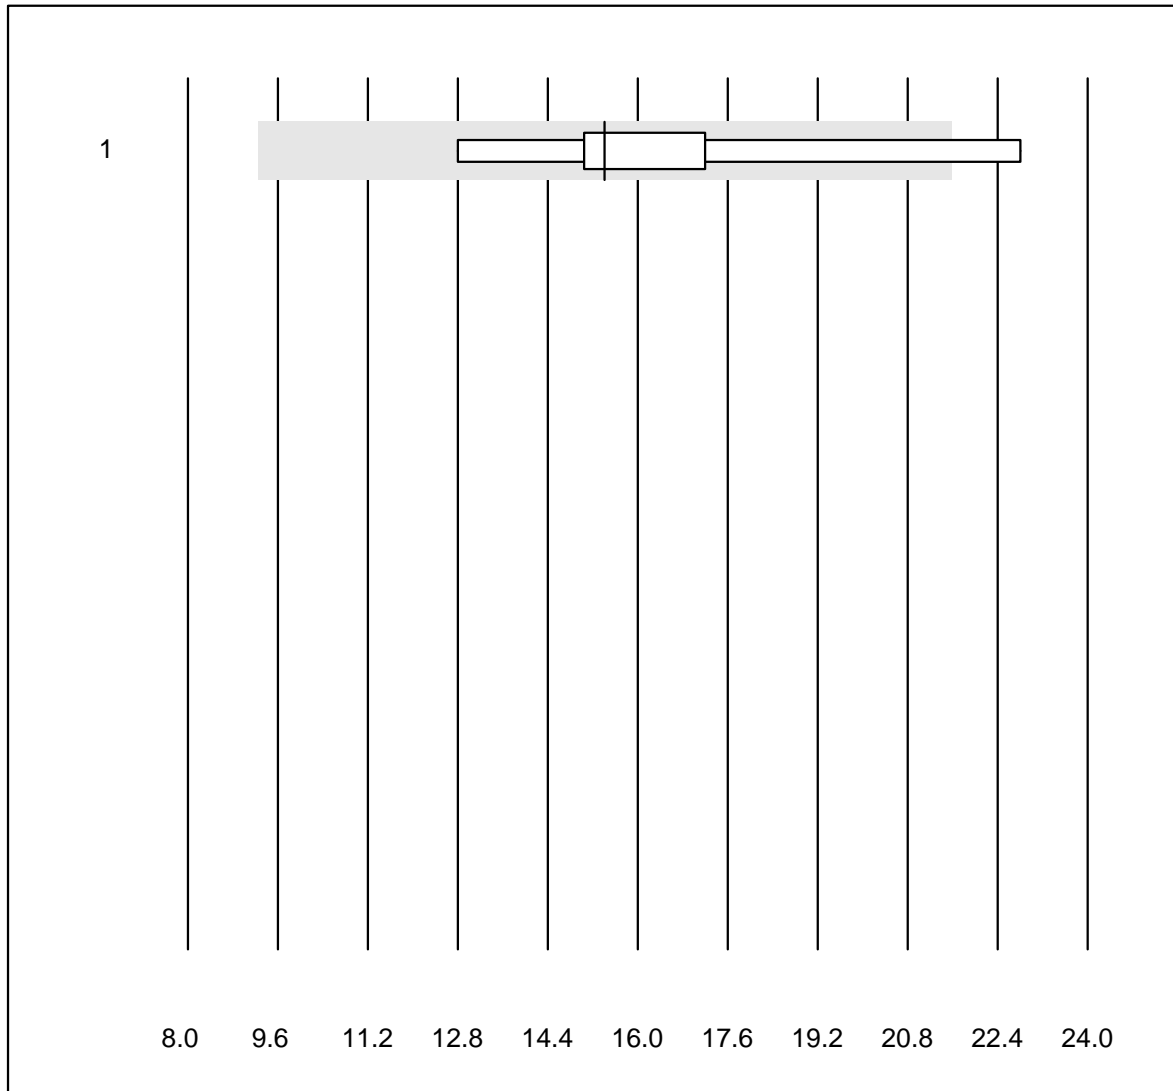


Tolérance MQ : 20 %

Osmotische Lücke (mmol/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Formel 1 (2Na+K+Glu+	11	72.7	9.1	18.2	15.4	18.5	a

Digoxin

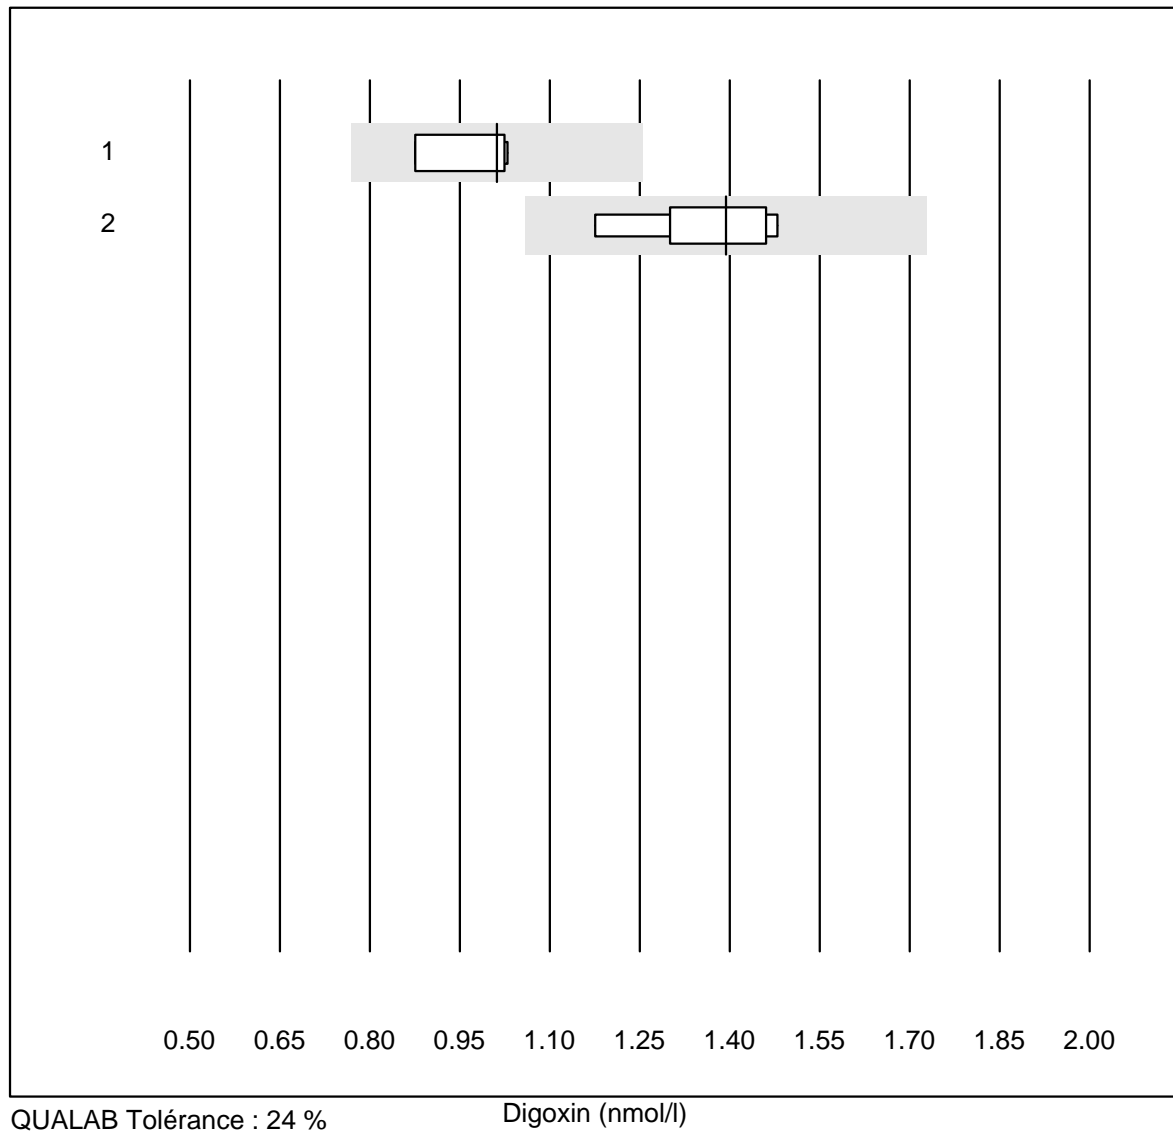


QUALAB Tolérance : 24 %

Digoxin (nmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Alinity	4	100.0	0.0	0.0	1.01	7.4	e*
2 Autres méthodes	6	100.0	0.0	0.0	1.39	8.3	e*

Valproat

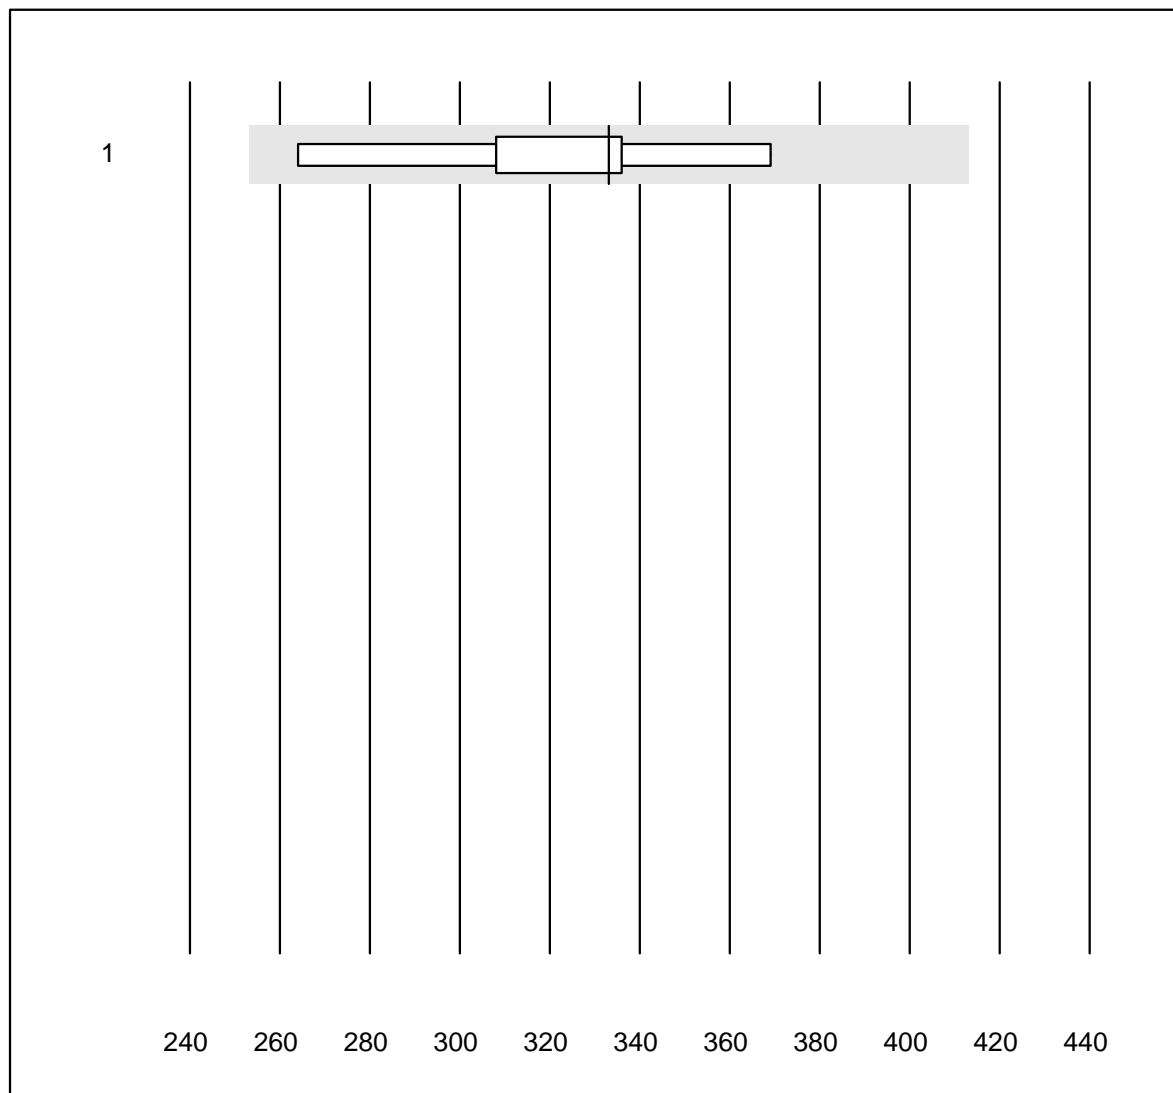


Tolérance MQ : 24 %

Valproat (µmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	333.1	10.1	e*

Cystatin C

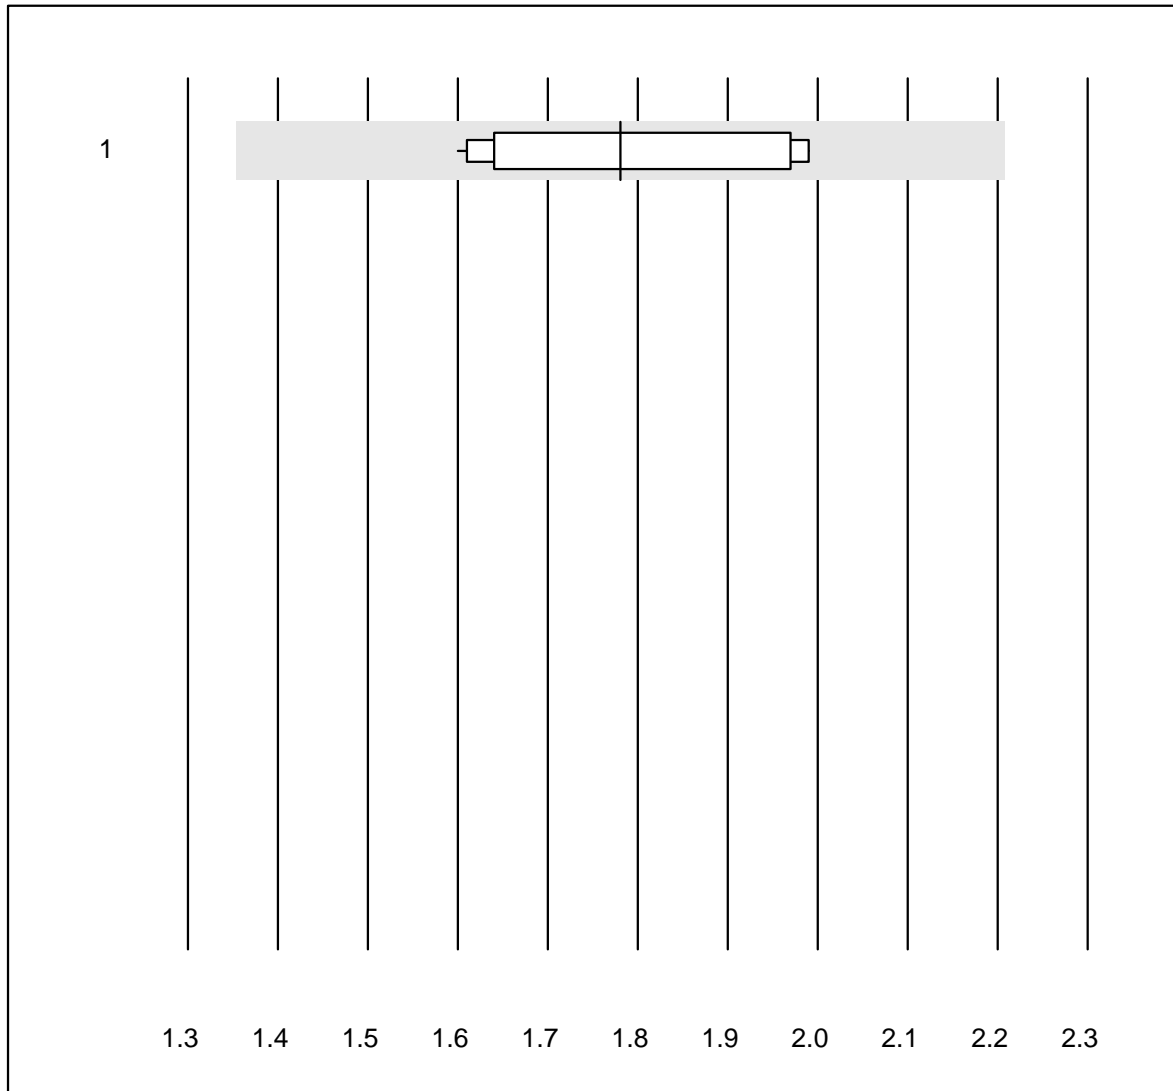


Tolérance MQ : 24 %

Cystatin C (mg/l)


No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	13	92.3	0.0	7.7	1.78	9.4	e

Éthanol

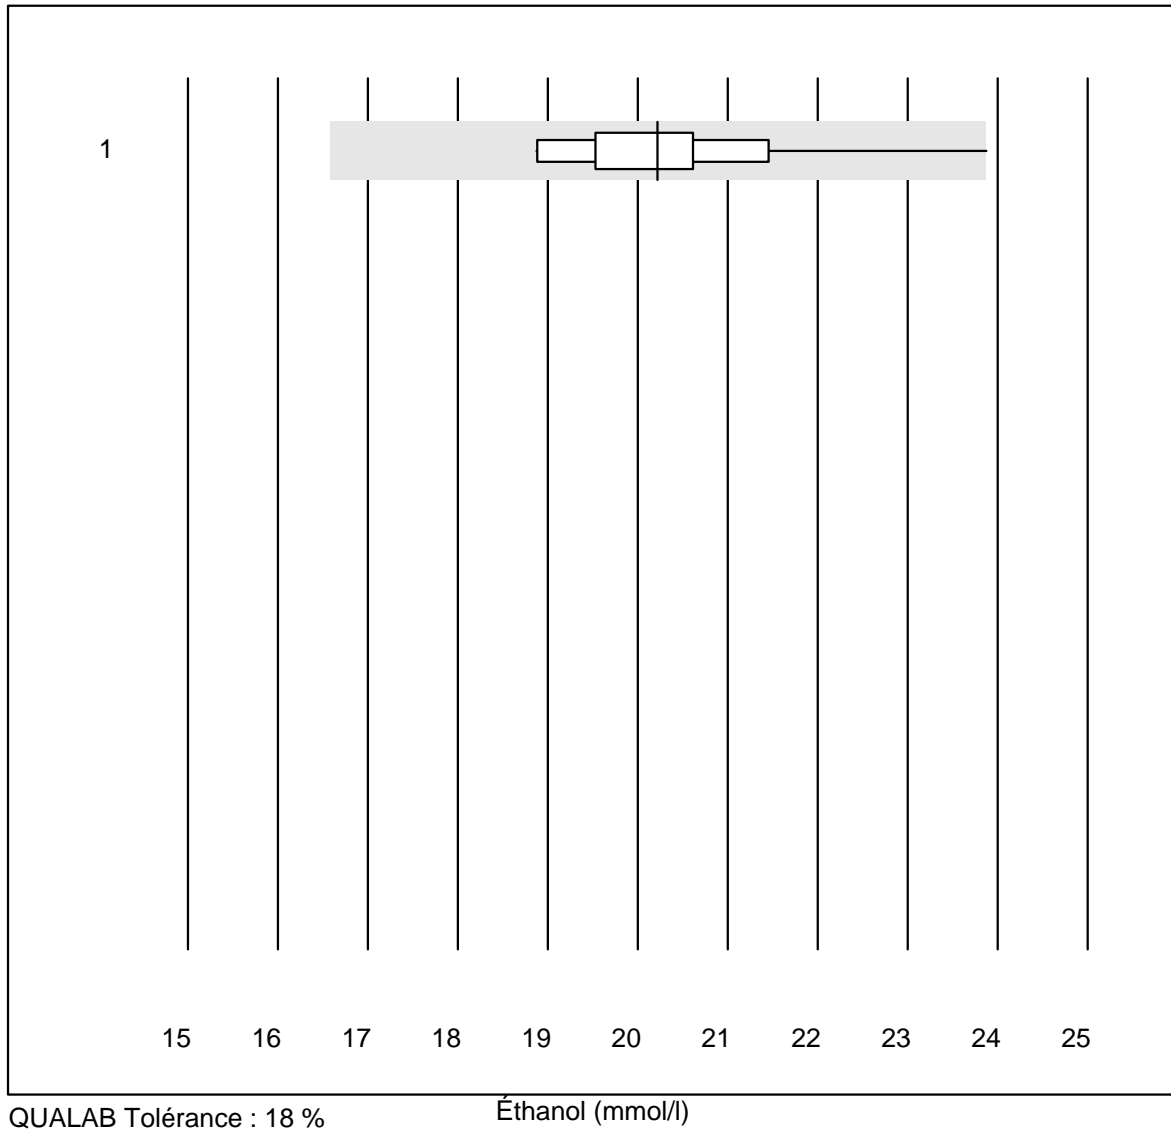

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	27	96.3	3.7	0.0	20.2	5.3	e

Ammoniac

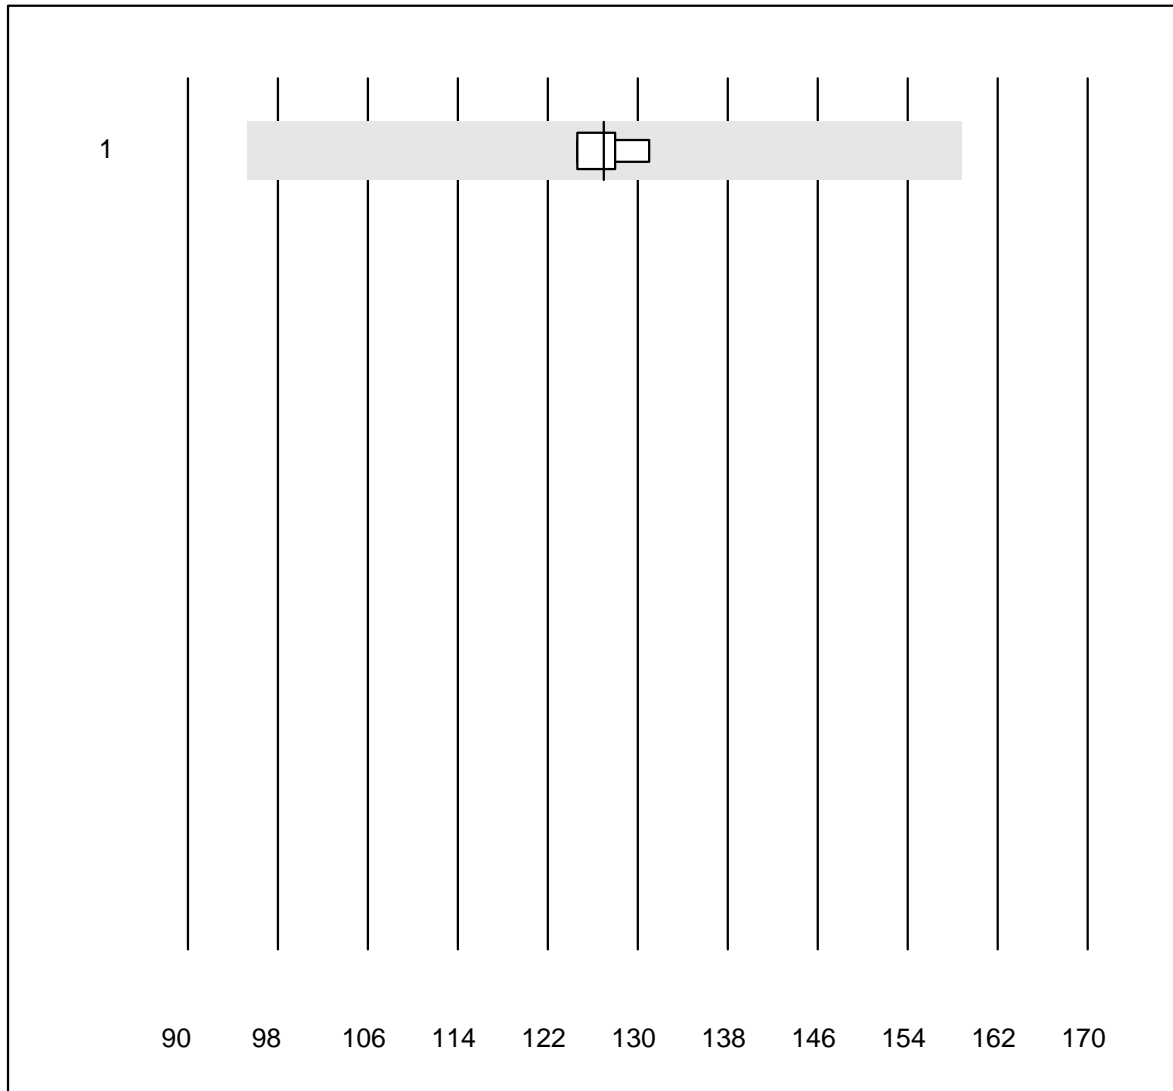


Tolérance MQ : 25 %

Ammoniac (µmol/l)


No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	127.0	2.2	e

Calprotectine

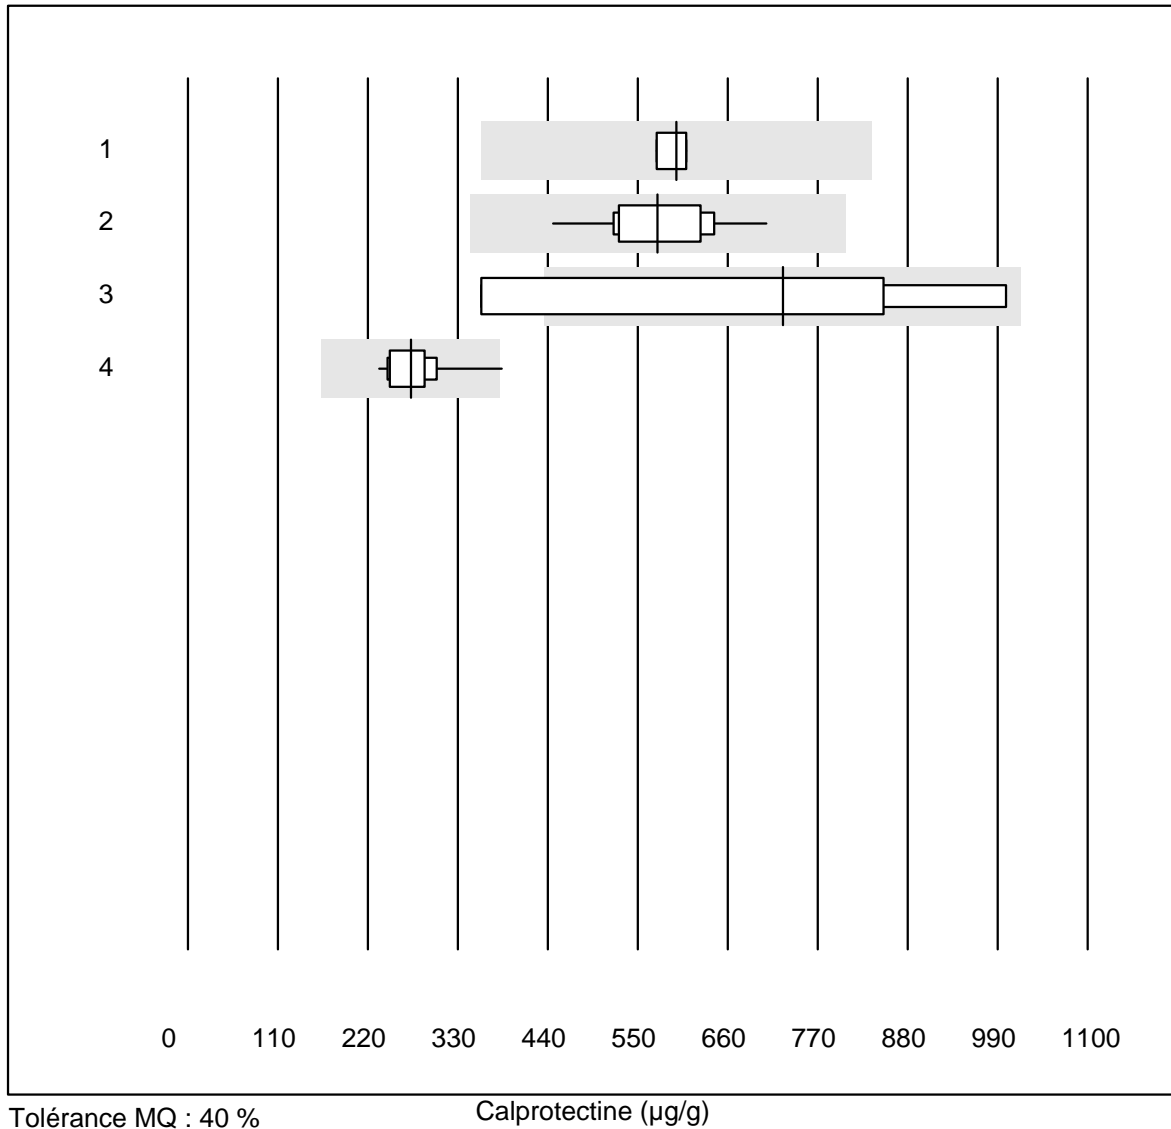

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Bühlmann ELISA	4	75.0	0.0	25.0	597	3.1	e
2 Bühlmann fCALturbo	14	78.6	0.0	21.4	574	12.3	e
3 Bühlmann Quantum Blu	4	75.0	25.0	0.0	728	40.0	e*
4 Liaison	23	95.7	4.3	0.0	273	11.9	e

Cholestérol Af/b101

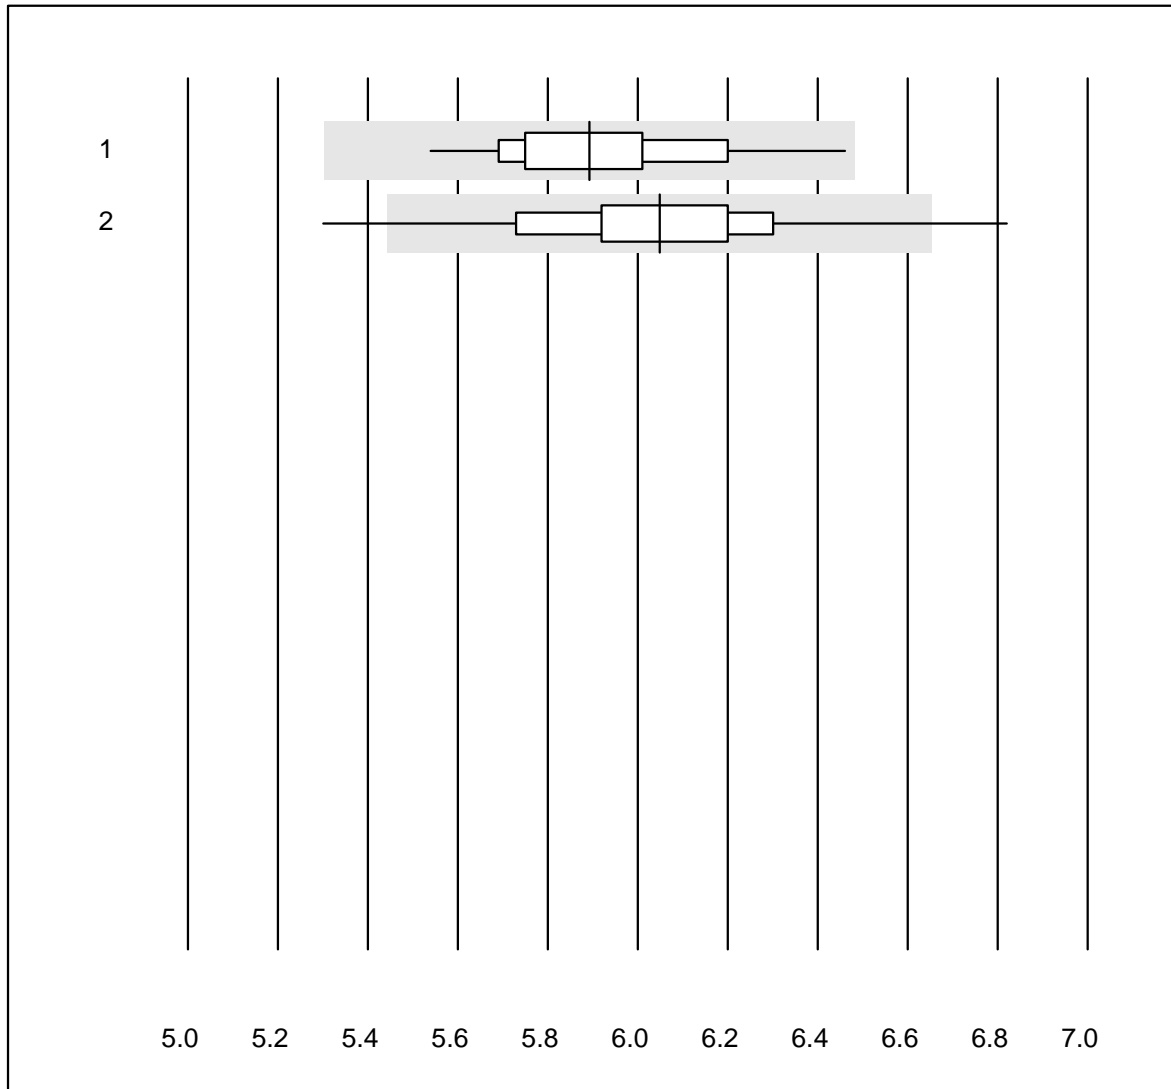


QUALAB Tolérance : 10 %

Cholestérol Af/b101 (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas b101	244	99.2	0.0	0.8	5.89	3.3	e
2 Afinion	454	98.4	0.7	0.9	6.05	3.6	e


Cholestérol HDL Af/b101

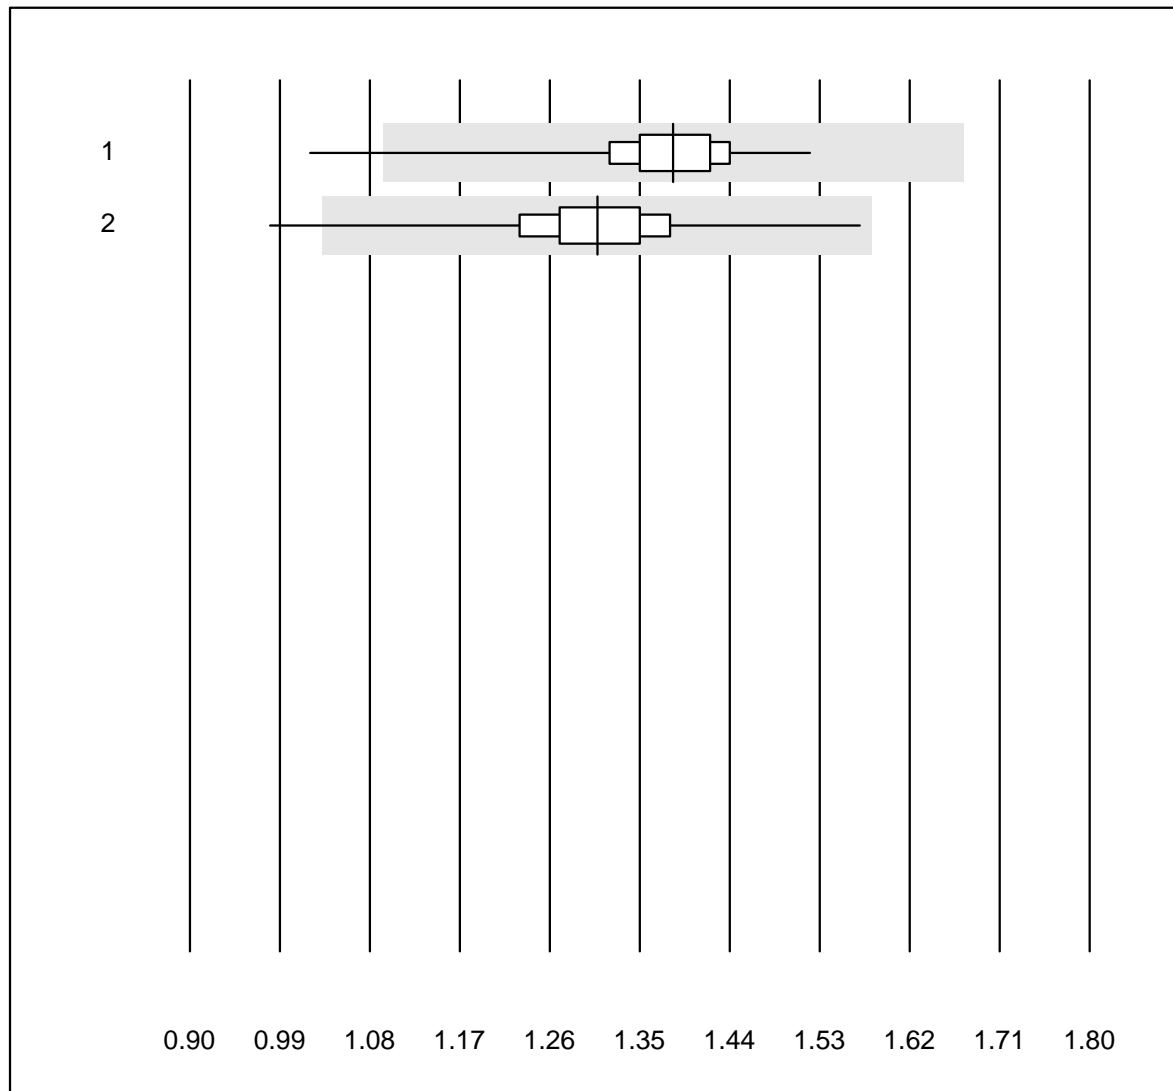

QUALAB Tolérance : 21 % Cholestérol HDL Af/b101 (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas b101	239	94.6	0.4	5.0	1.38	4.1	e
2 Afinion	451	94.0	0.2	5.8	1.31	4.8	e

Triglycerides Af/b101

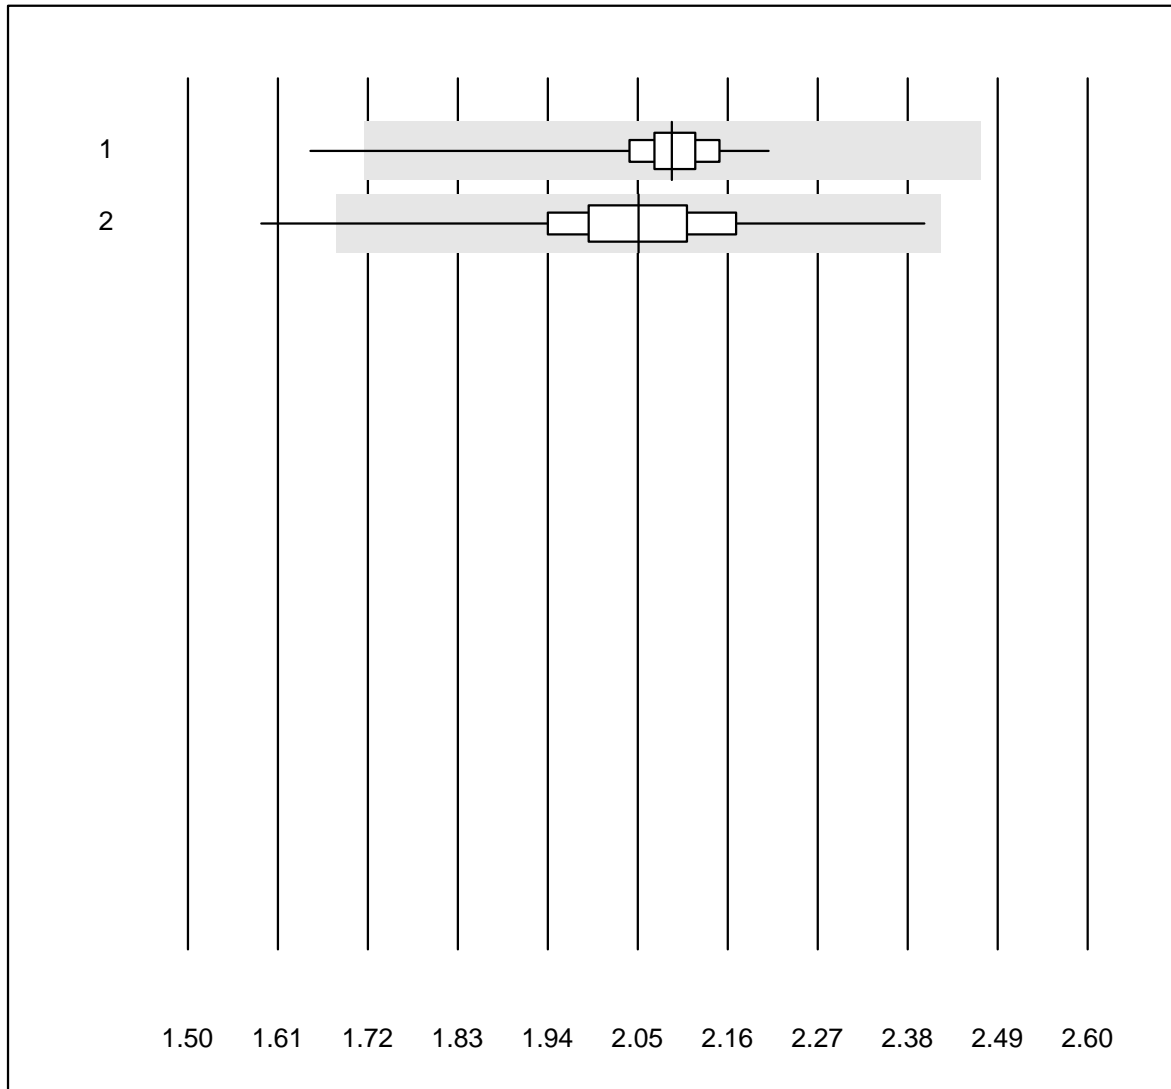


QUALAB Tolérance : 18 %

Triglycerides Af/b101 (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas b101	241	98.8	0.4	0.8	2.09	2.4	e
2 Afinion	456	99.4	0.2	0.4	2.05	4.4	e

Troponine I S

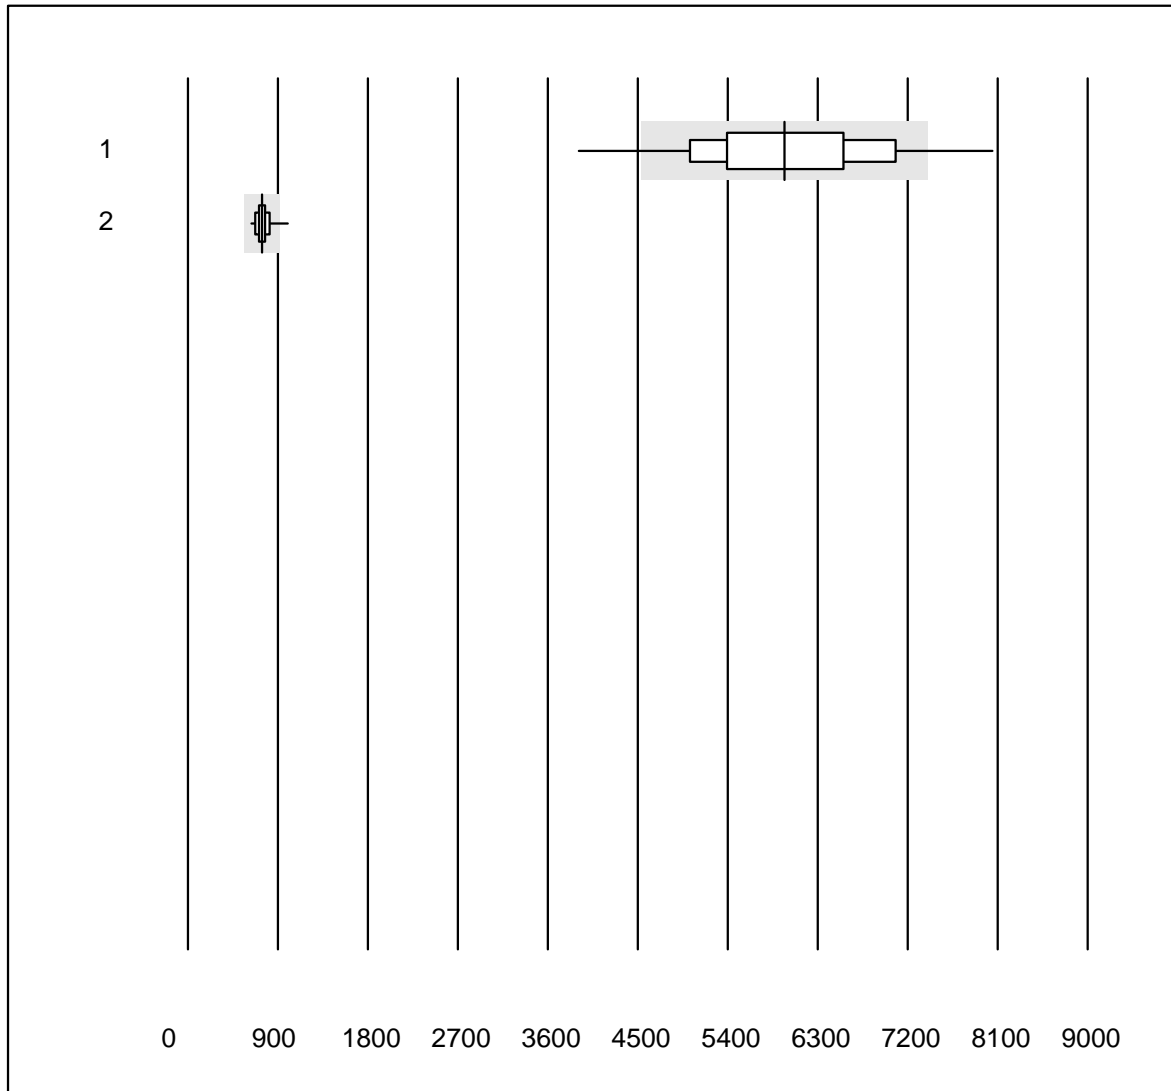


QUALAB Tolérance : 24 %

Troponine I S (ng/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 AFIAS (Gen. 1)	132	82.6	10.6	6.8	5965.34	14.1	e
2 AFIAS	57	94.7	1.8	3.5	740.92	8.0	e

D-Dimères qn S

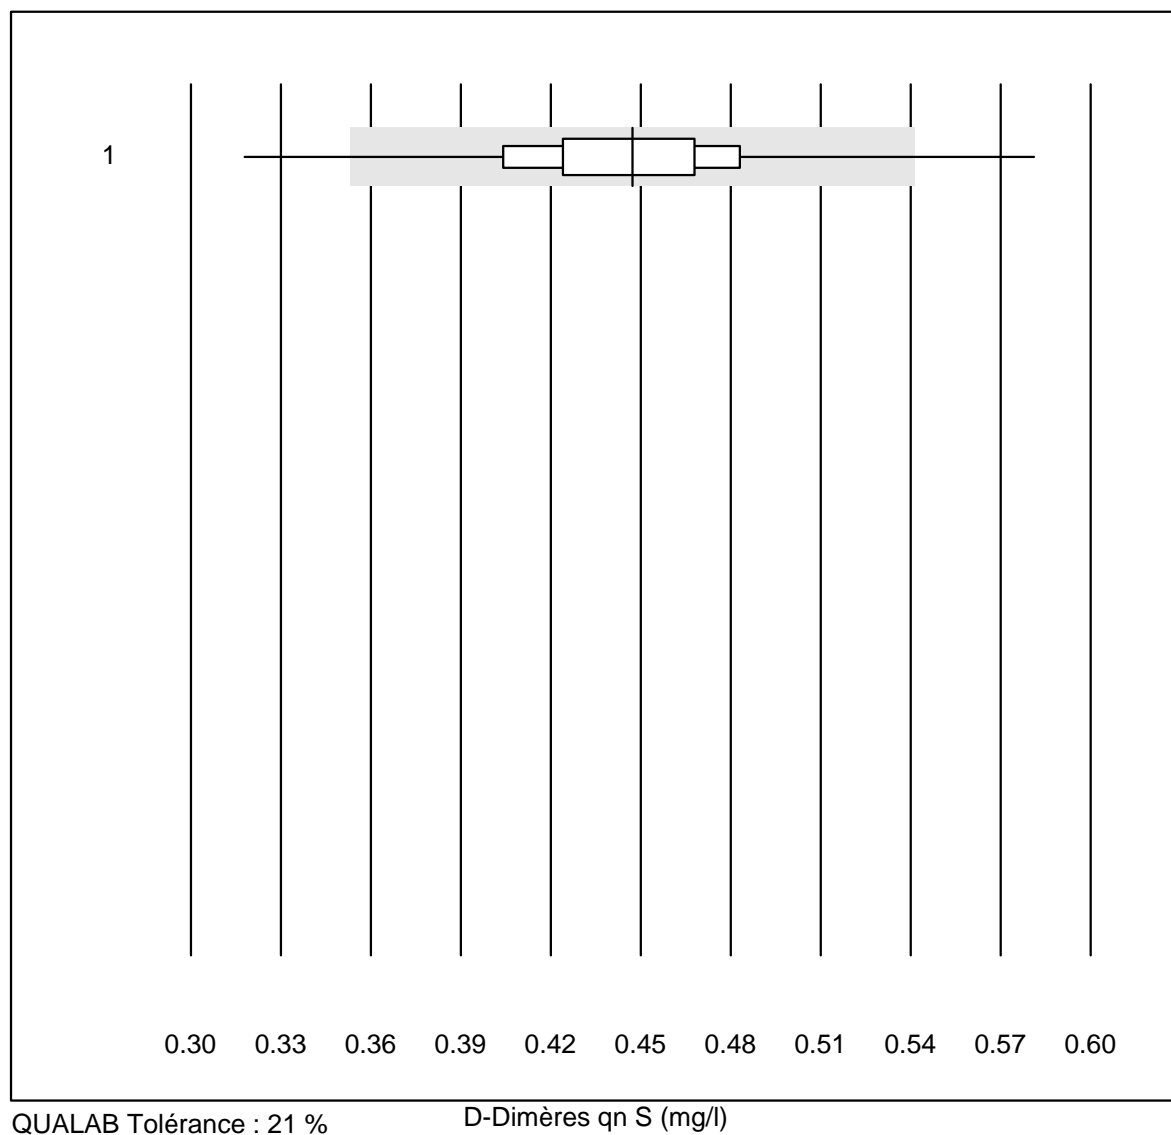

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 AFIAS	194	88.6	2.6	8.8	0.45	8.0	e

NT-proBNP S

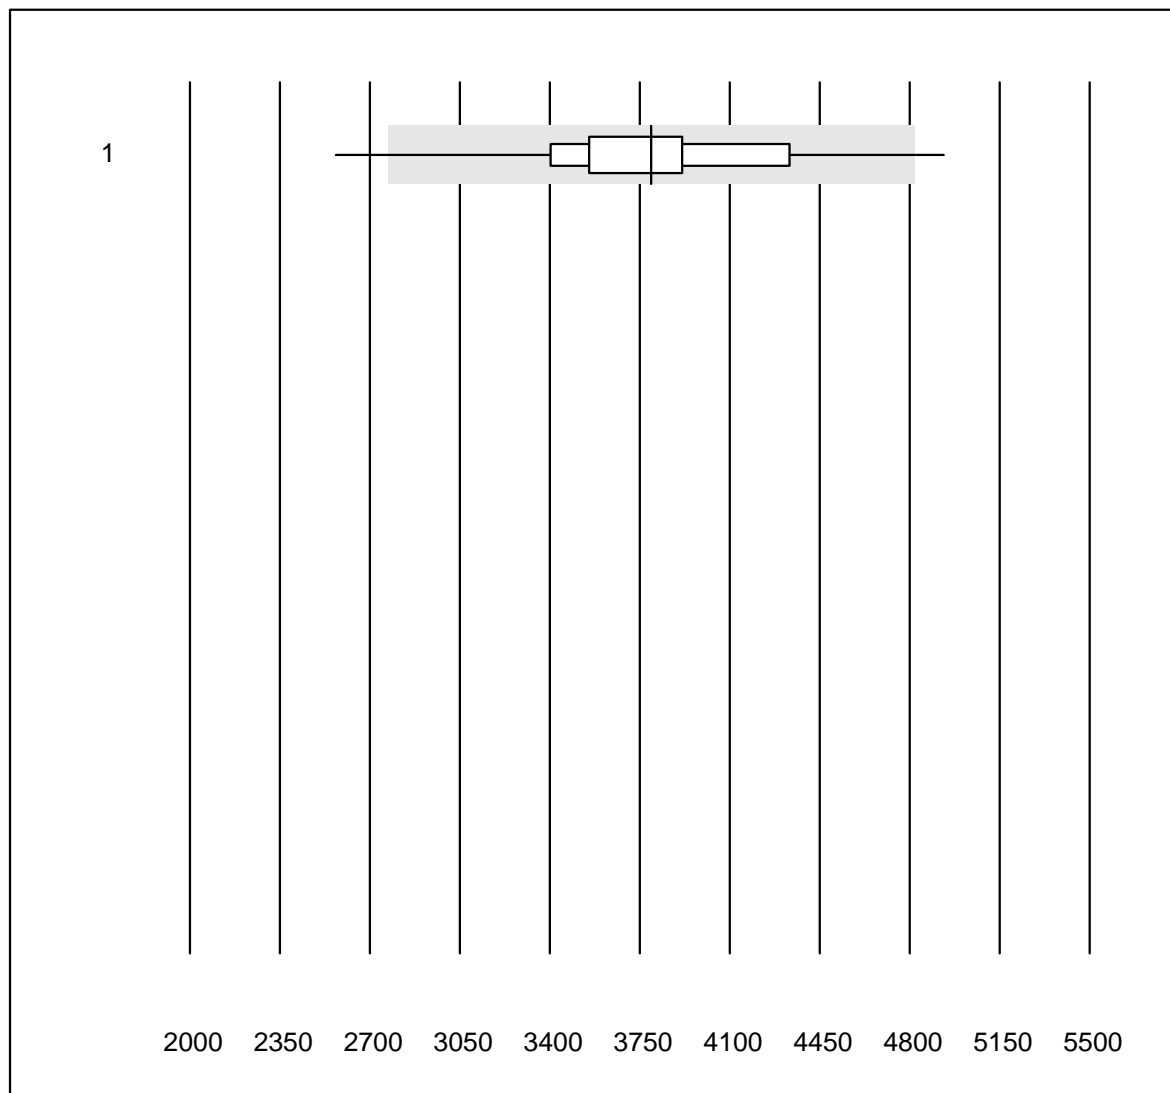


QUALAB Tolérance : 27 %

NT-proBNP S (ng/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 AFIAS	145	93.8	1.4	4.8	3793.6	9.9	e

Lipase

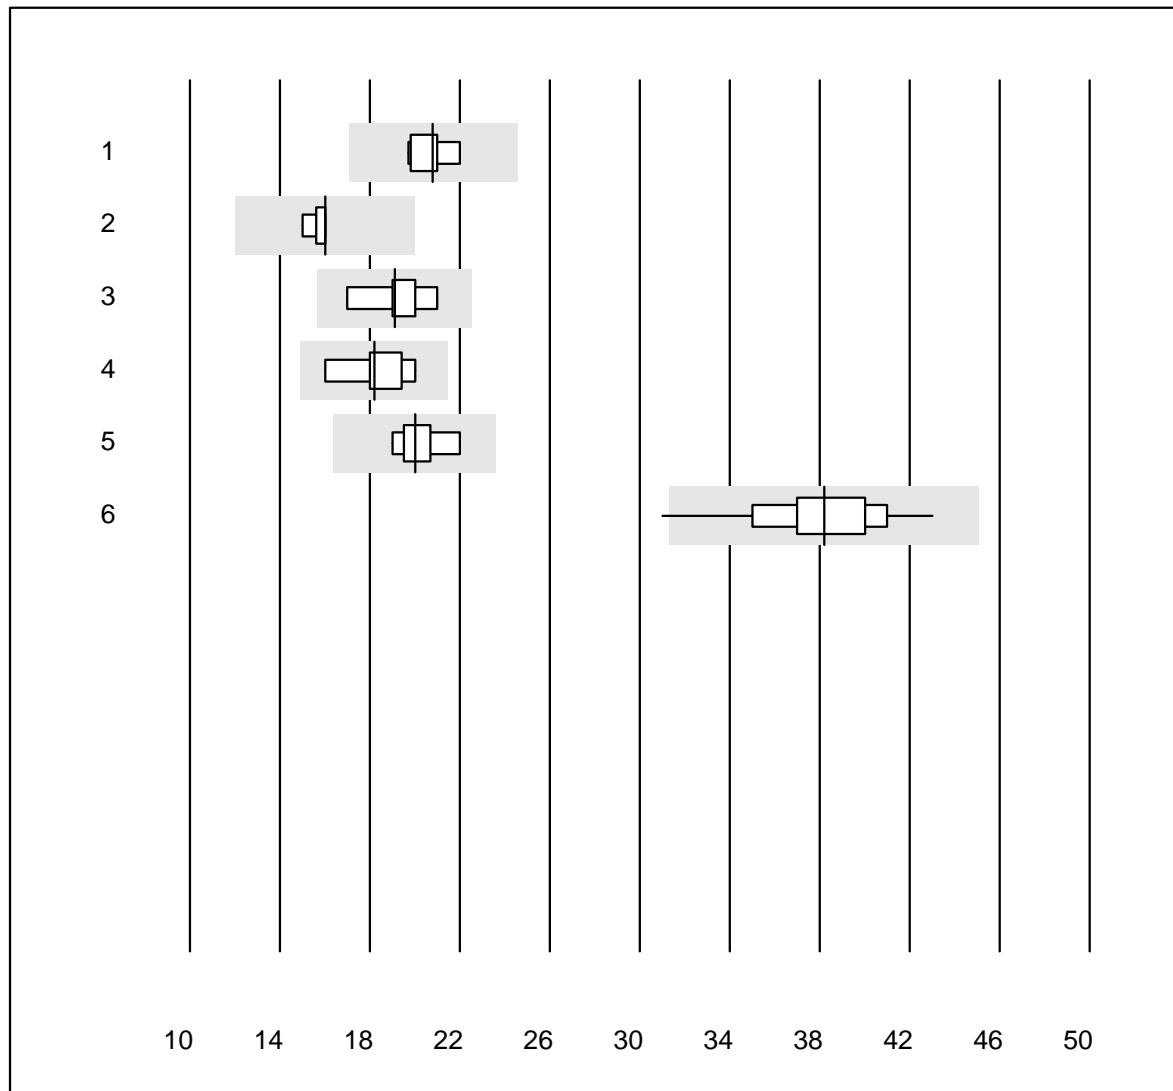


QUALAB Tolérance : 18 %
(< 18.0: +/- 4.0 U/l)

Lipase (U/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	Roche	5	100.0	0.0	0.0	20.8	4.6	e
2	Alinity	6	100.0	0.0	0.0	16.0	2.6	e
3	Architect	7	100.0	0.0	0.0	19.1	6.5	e*
4	Beckman	5	100.0	0.0	0.0	18.2	8.4	e*
5	Cobas	9	100.0	0.0	0.0	20.0	4.7	e
6	Fuji Dri-Chem	172	98.8	0.6	0.6	38.2	6.0	e

Bicarbonat

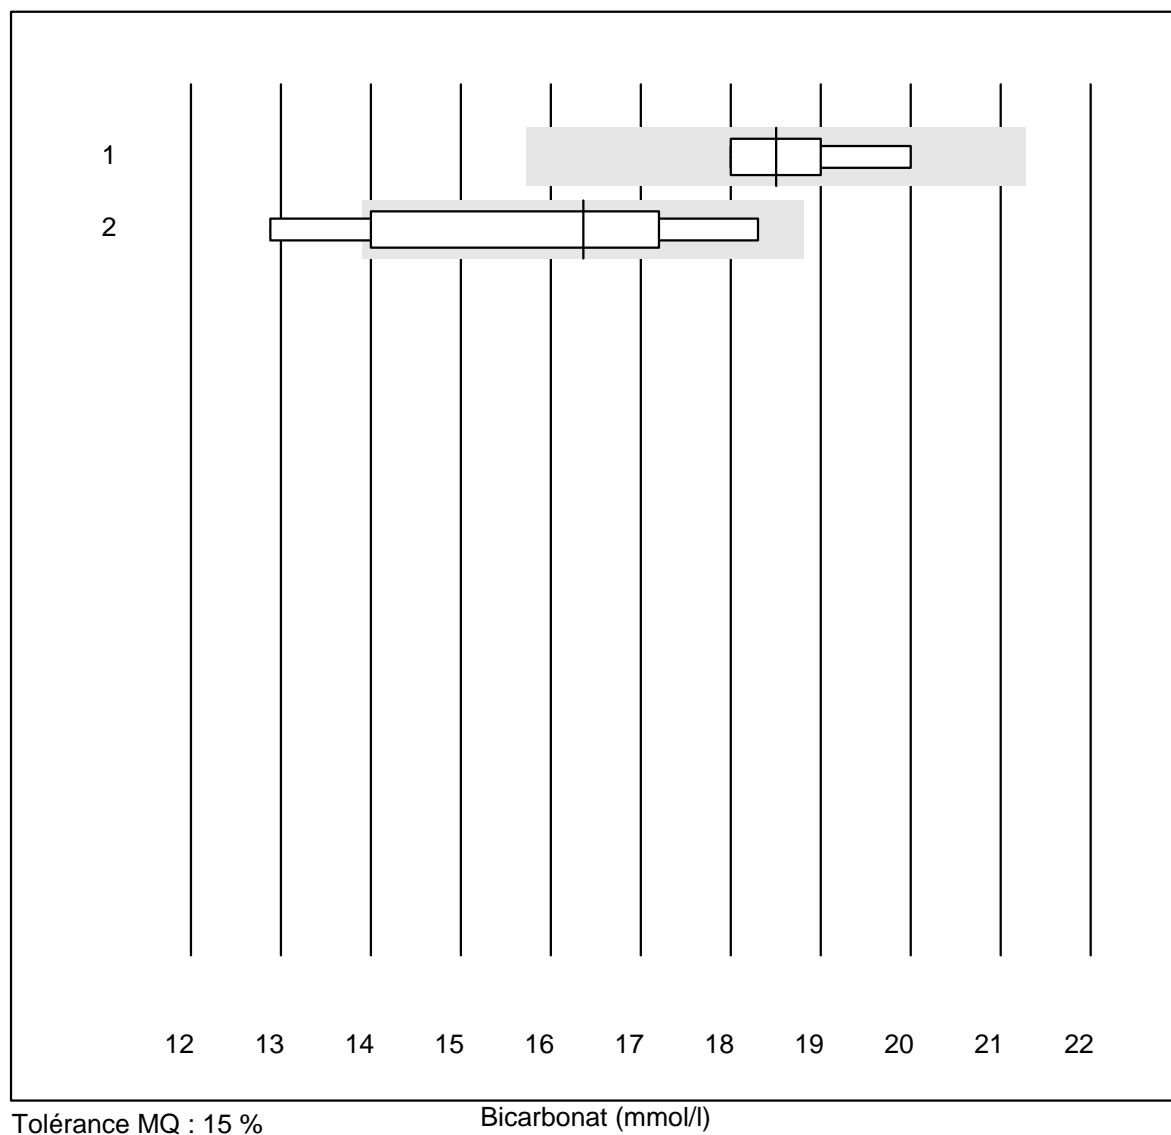


Tolérance MQ : 15 %

Bicarbonat (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Piccolo	4	100.0	0.0	0.0	18.5	5.1	e*
2 Autres méthodes	5	80.0	20.0	0.0	16.4	14.2	a

Glucose CSF

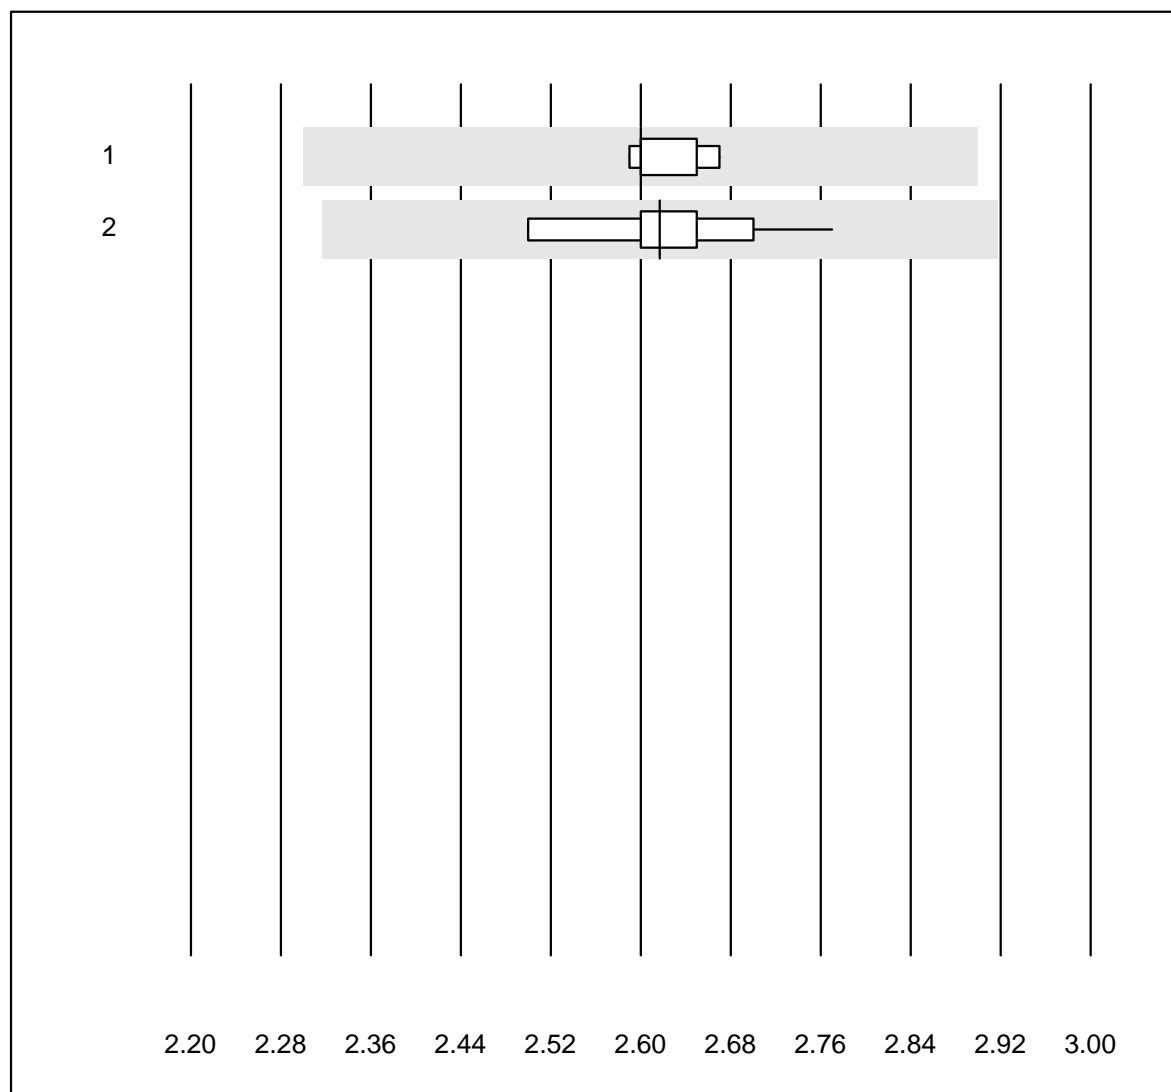


QUALAB Tolérance : 9 %
(< 3.30: +/- 0.30 mmol/l)

Glucose CSF (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	2.60	1.4	e
2 Autres méthodes	10	100.0	0.0	0.0	2.62	3.1	e

Lactate CSF

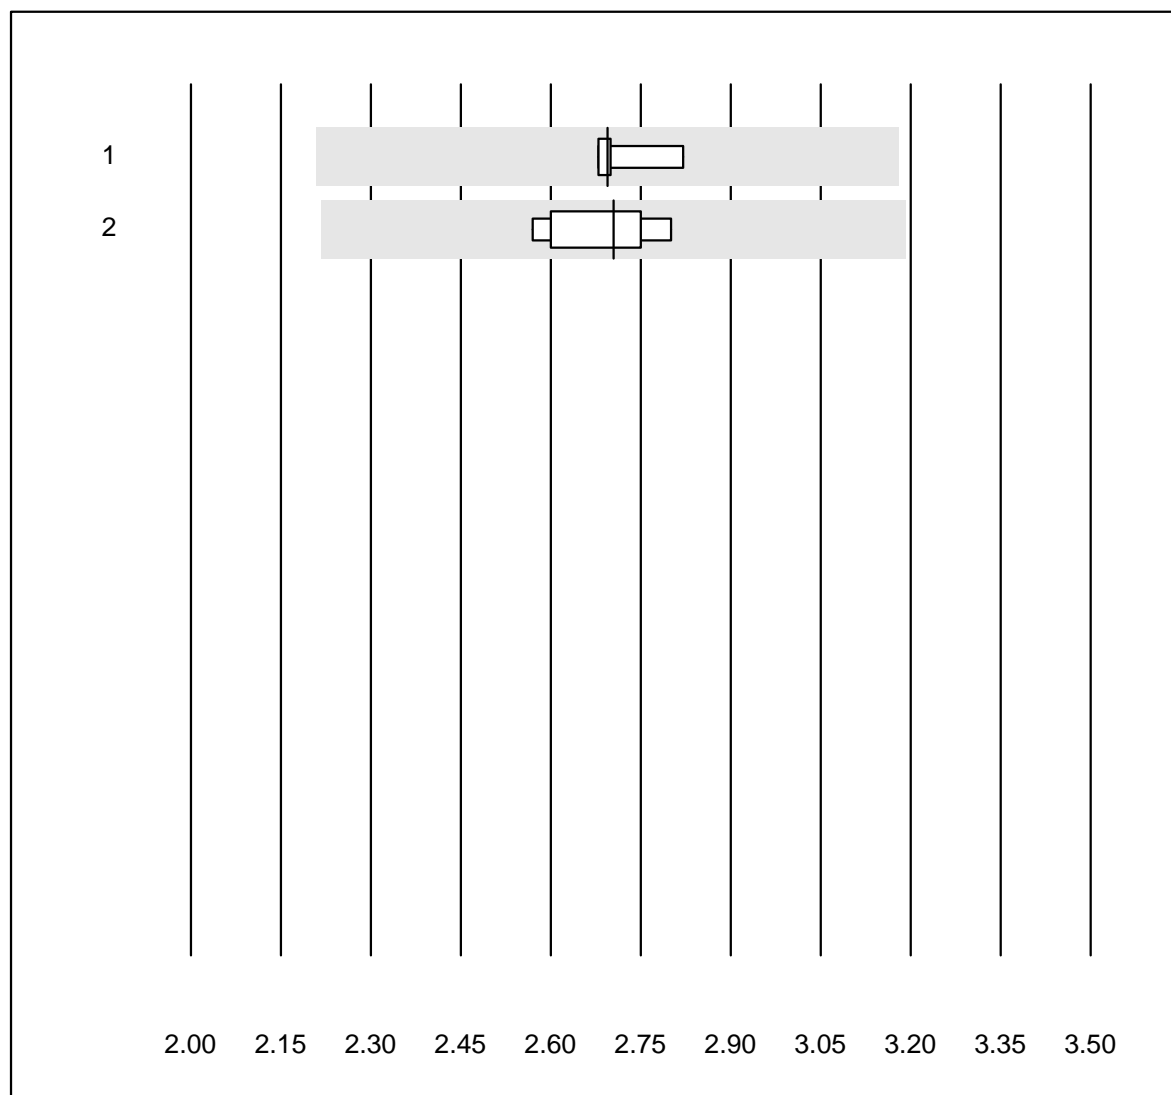


QUALAB Tolérance : 18 %

Lactate CSF (mmol/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	2.70	2.4	e
2 Autres méthodes	8	100.0	0.0	0.0	2.71	3.1	e

Protéine CSF

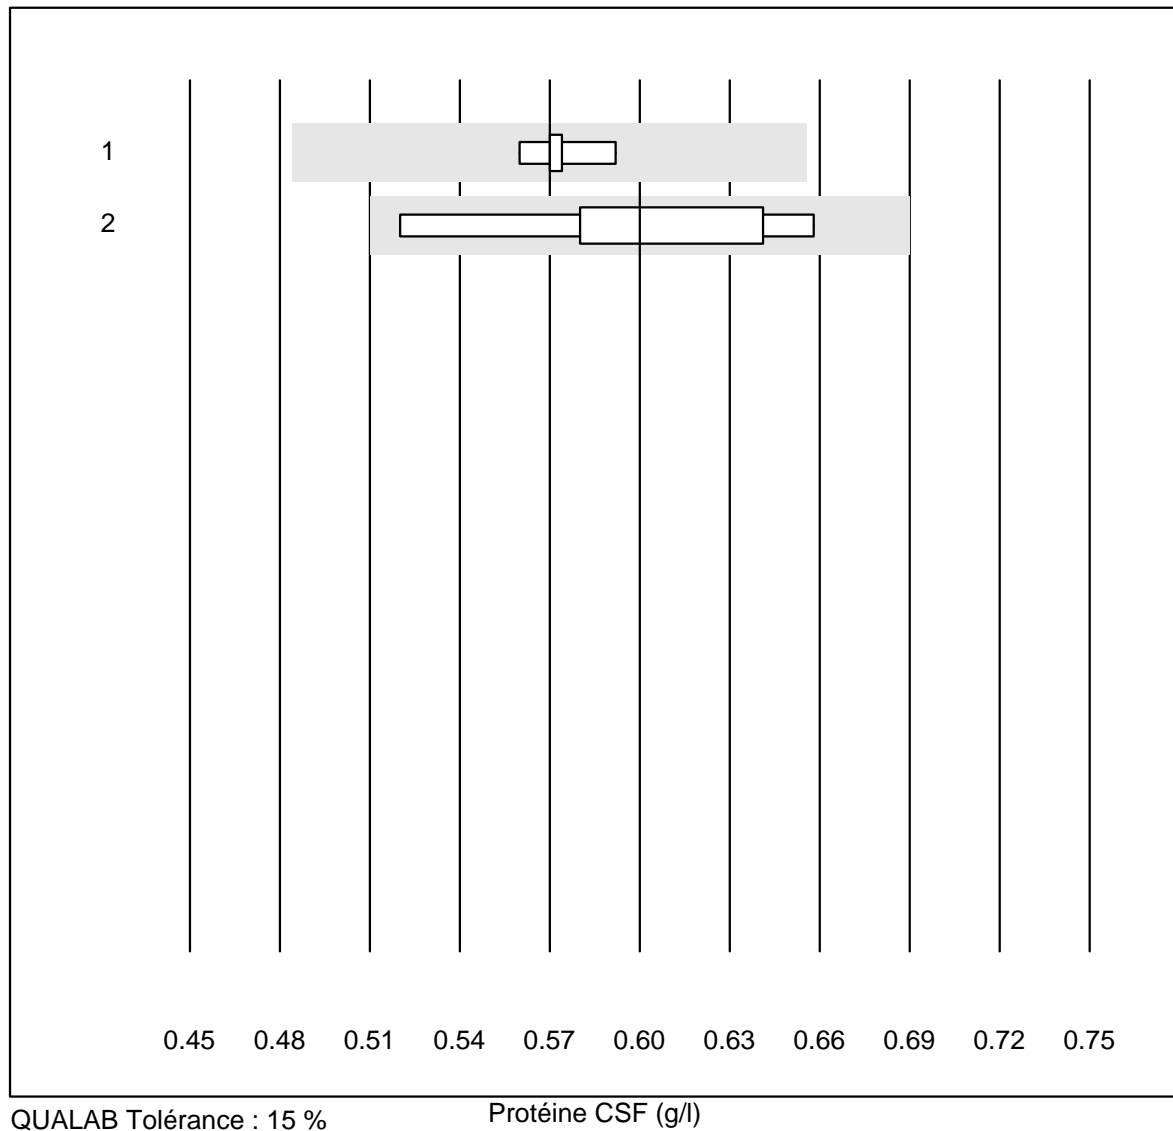

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	0.57	2.0	e
2 Autres méthodes	7	100.0	0.0	0.0	0.60	7.7	e*

Albumine CSF

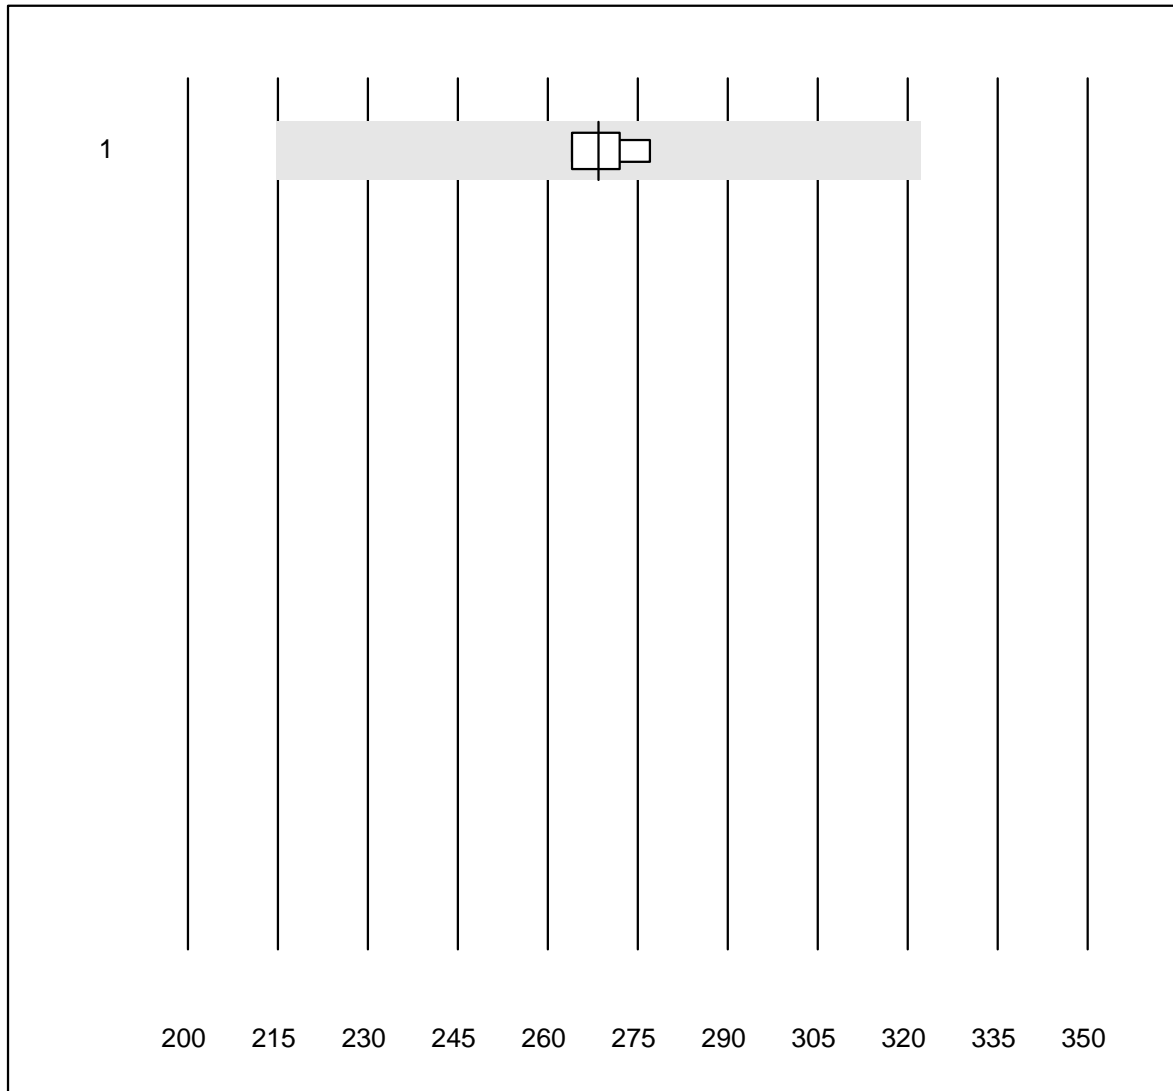


Tolérance MQ : 20 %

Albumine CSF (mg/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	4	100.0	0.0	0.0	268.50	2.3	e

CDT

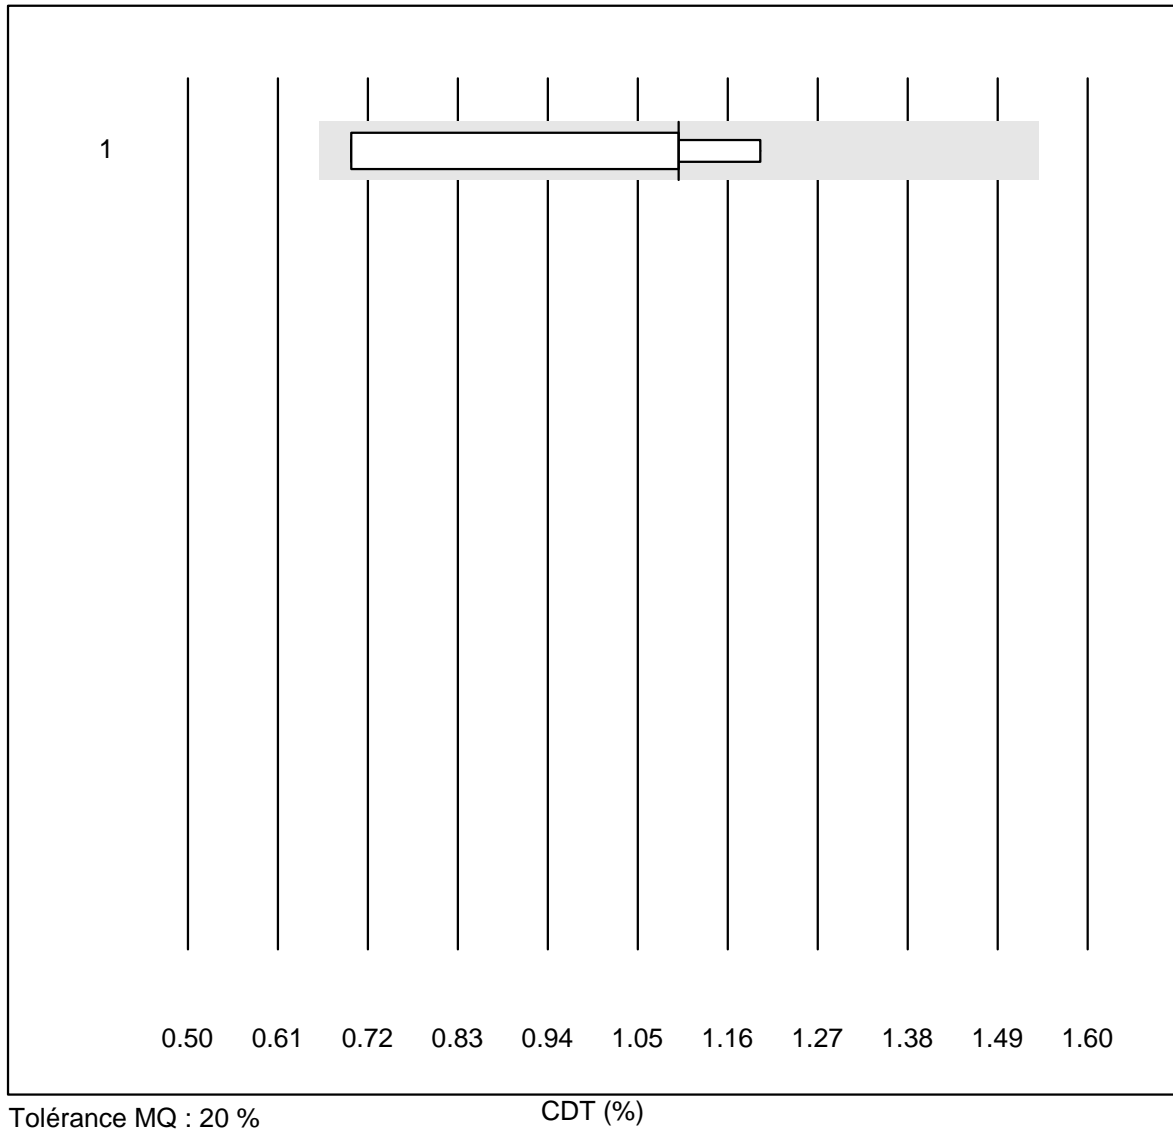


No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	1.10	21.6	a

Tacrolimus

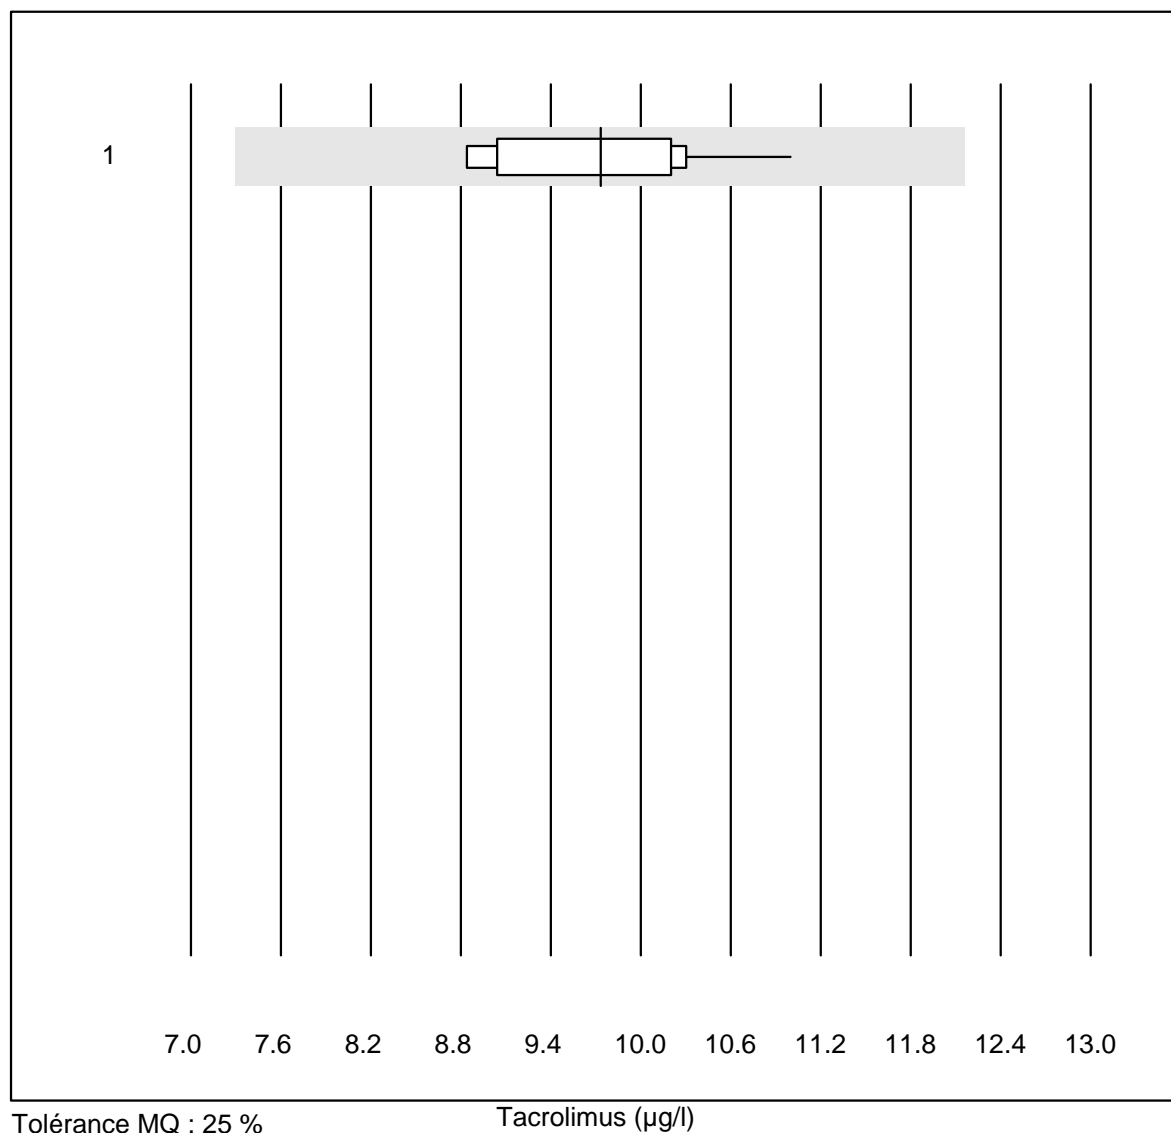

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	10	100.0	0.0	0.0	9.7	7.3	e

Totalprotein E

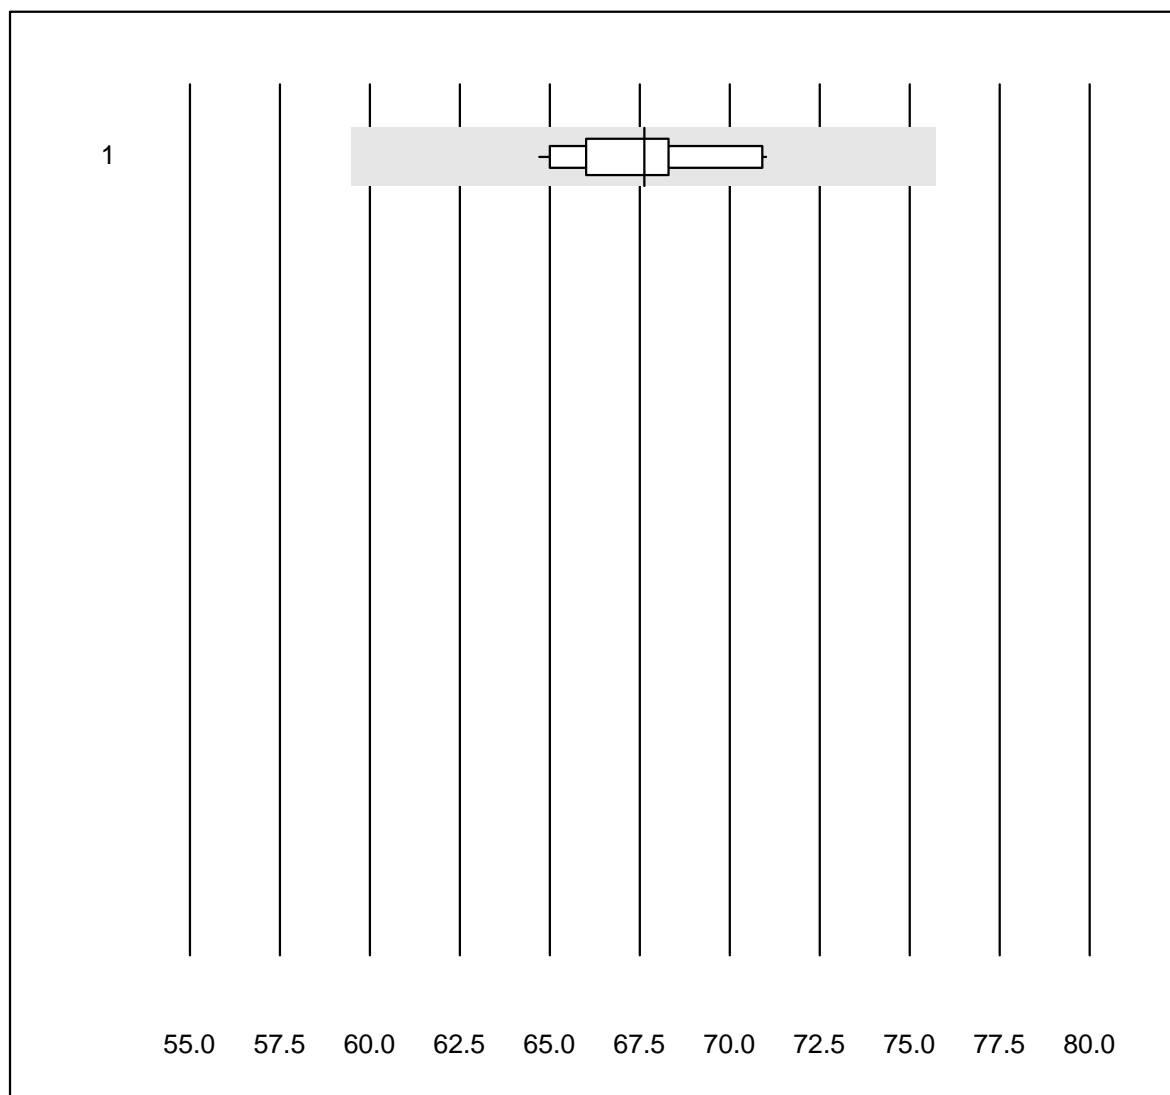


Tolérance MQ : 12 %

Totalprotein E (g/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	16	100.0	0.0	0.0	67.6	2.7	e

Albumin E

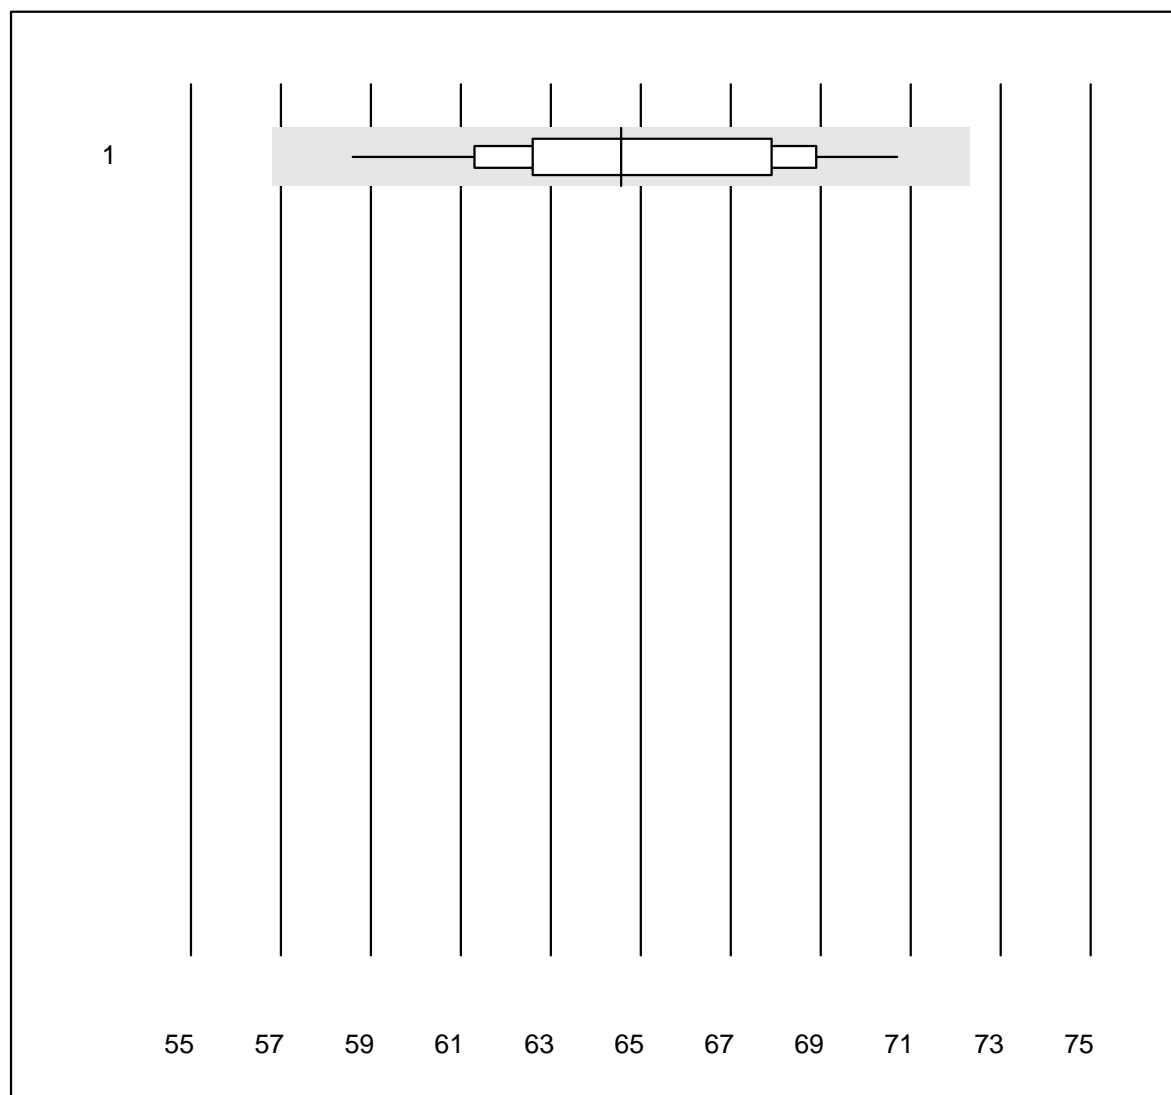


Tolérance MQ : 12 %

Albumin E (%)


No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 électrophorèse	22	100.0	0.0	0.0	64.6	5.3	e

alpha-1-Globuline

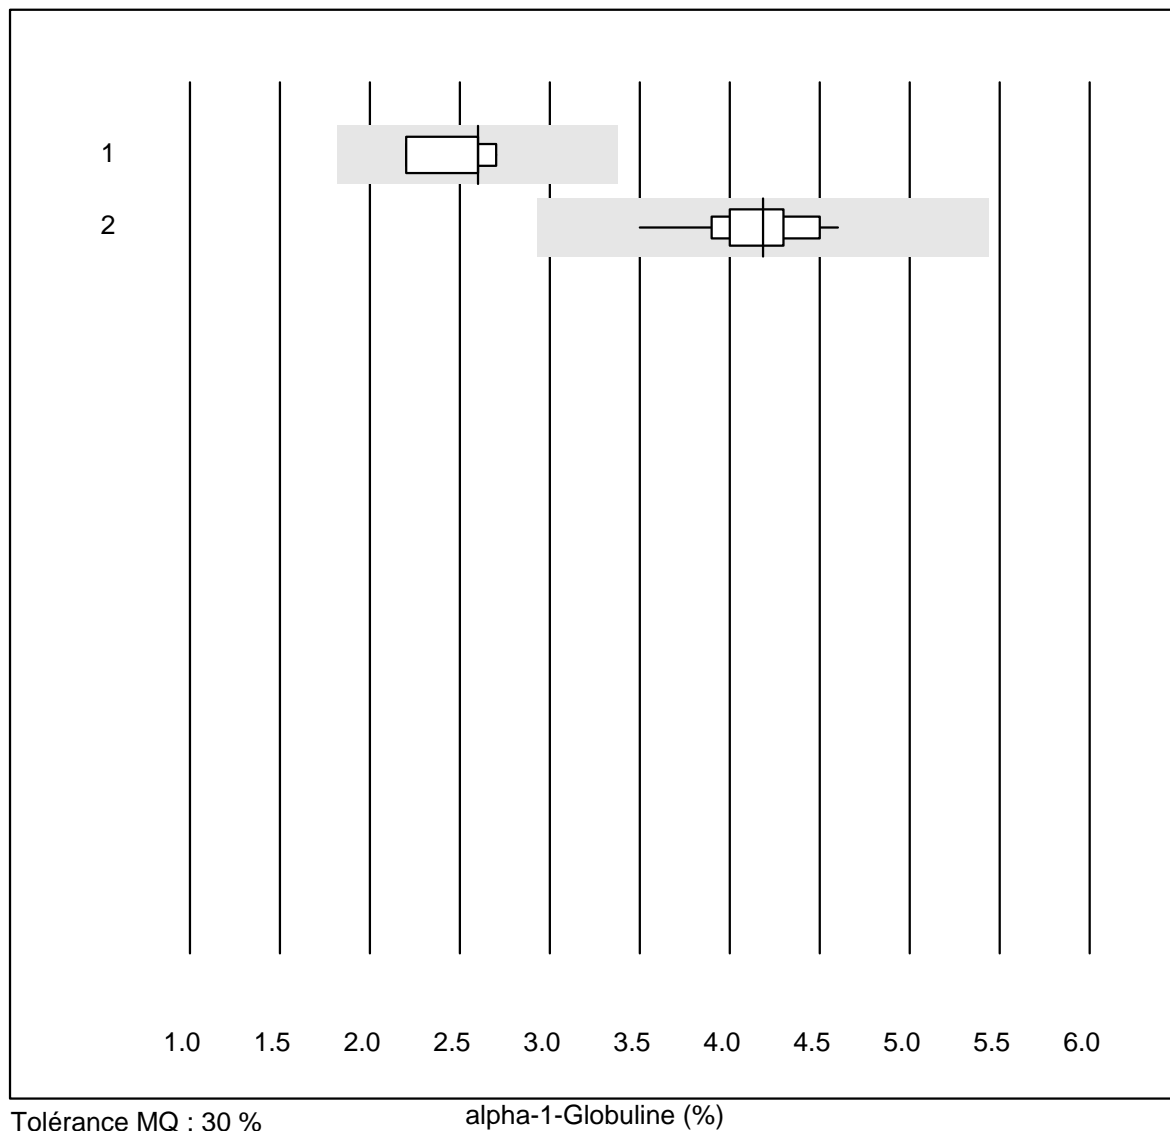

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 électrophorèse	9	100.0	0.0	0.0	2.6	8.8	e
2 électrophorèse capil	12	100.0	0.0	0.0	4.2	7.0	e

alpha-2-Globuline

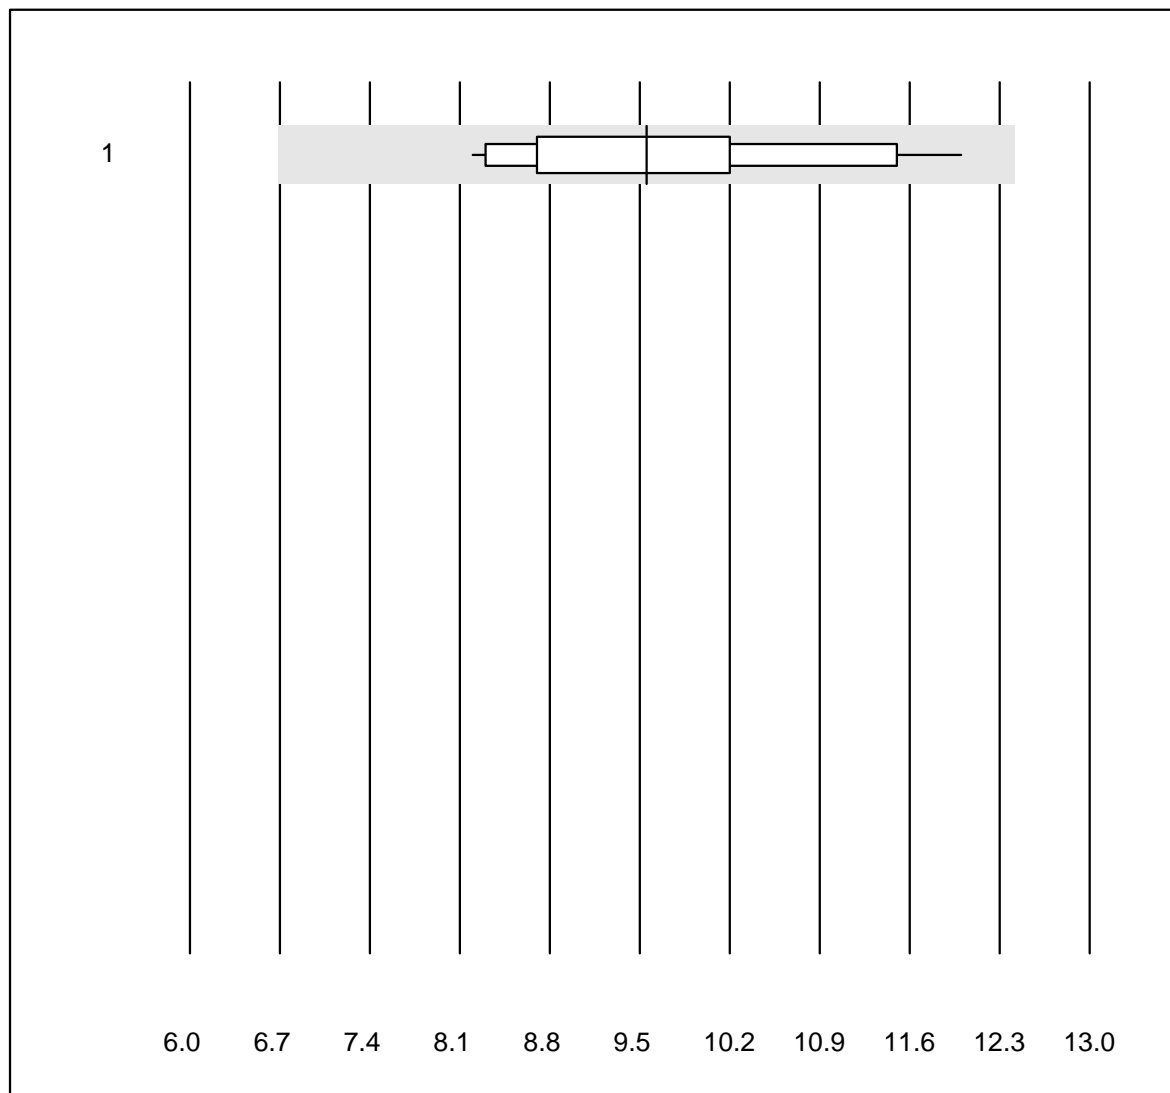


Tolérance MQ : 30 %

alpha-2-Globuline (%)


No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 électrophorèse	21	100.0	0.0	0.0	9.6	12.5	e

beta-Globuline

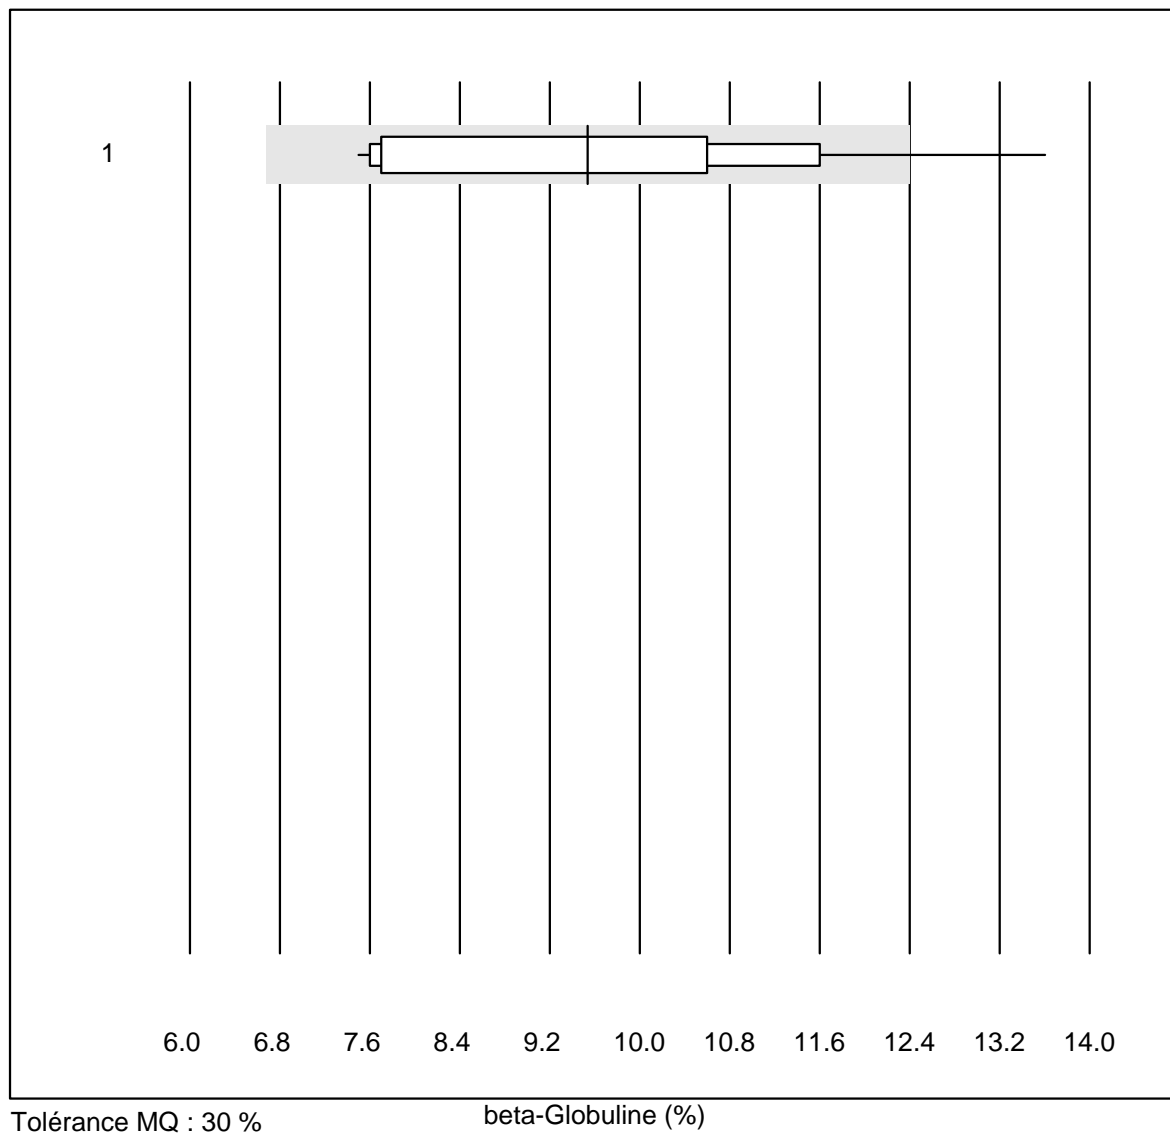

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 électrophorèse	16	93.7	6.3	0.0	9.5	18.9	e*

Beta-1-Globulin

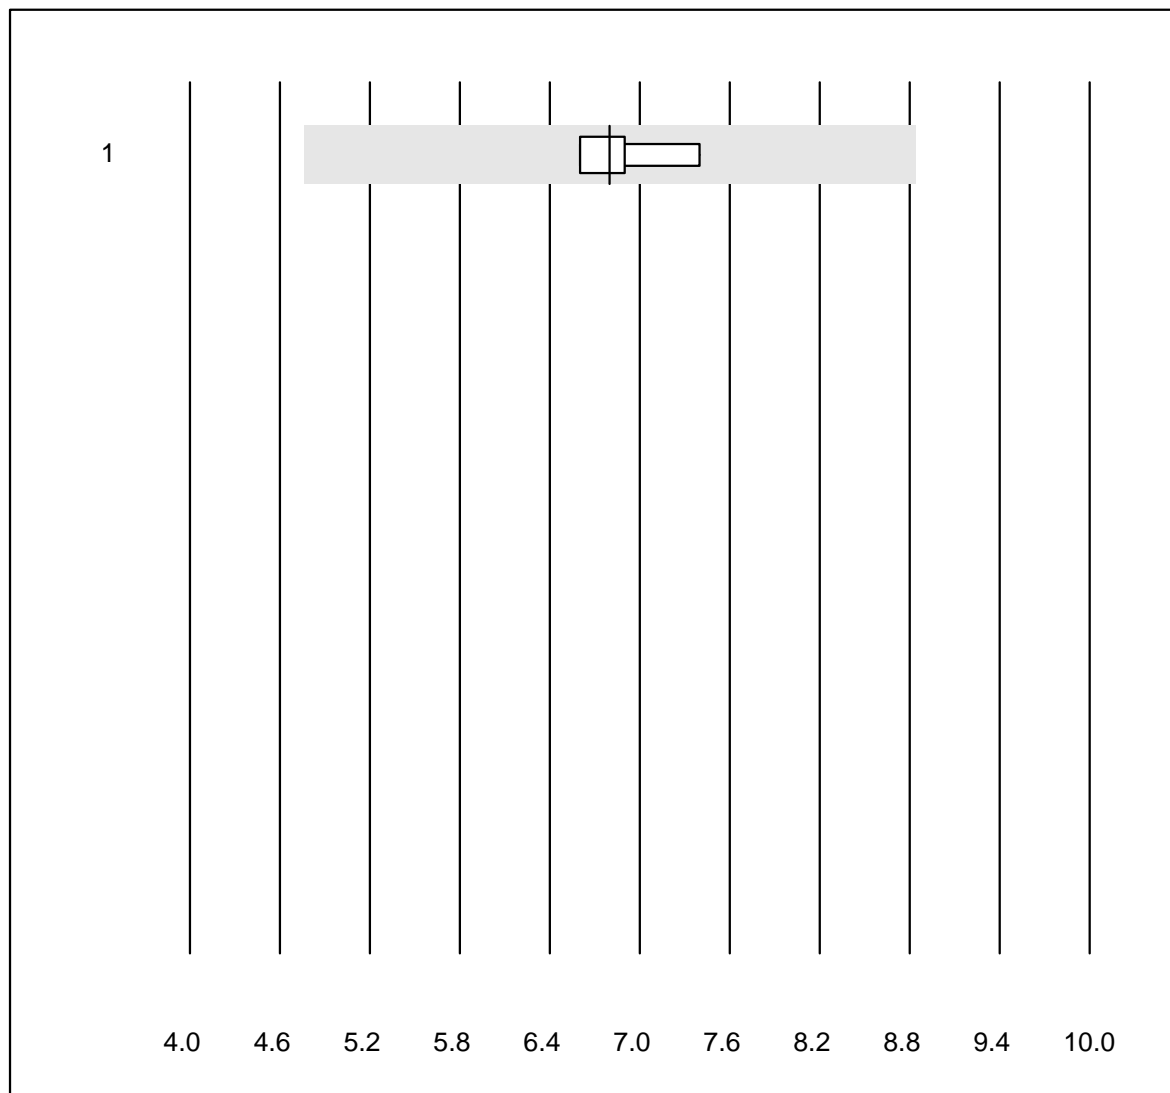


Tolérance MQ : 30 %

Beta-1-Globulin (%)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 électrophorèse	7	100.0	0.0	0.0	6.8	4.0	e

Beta-2-Globulin

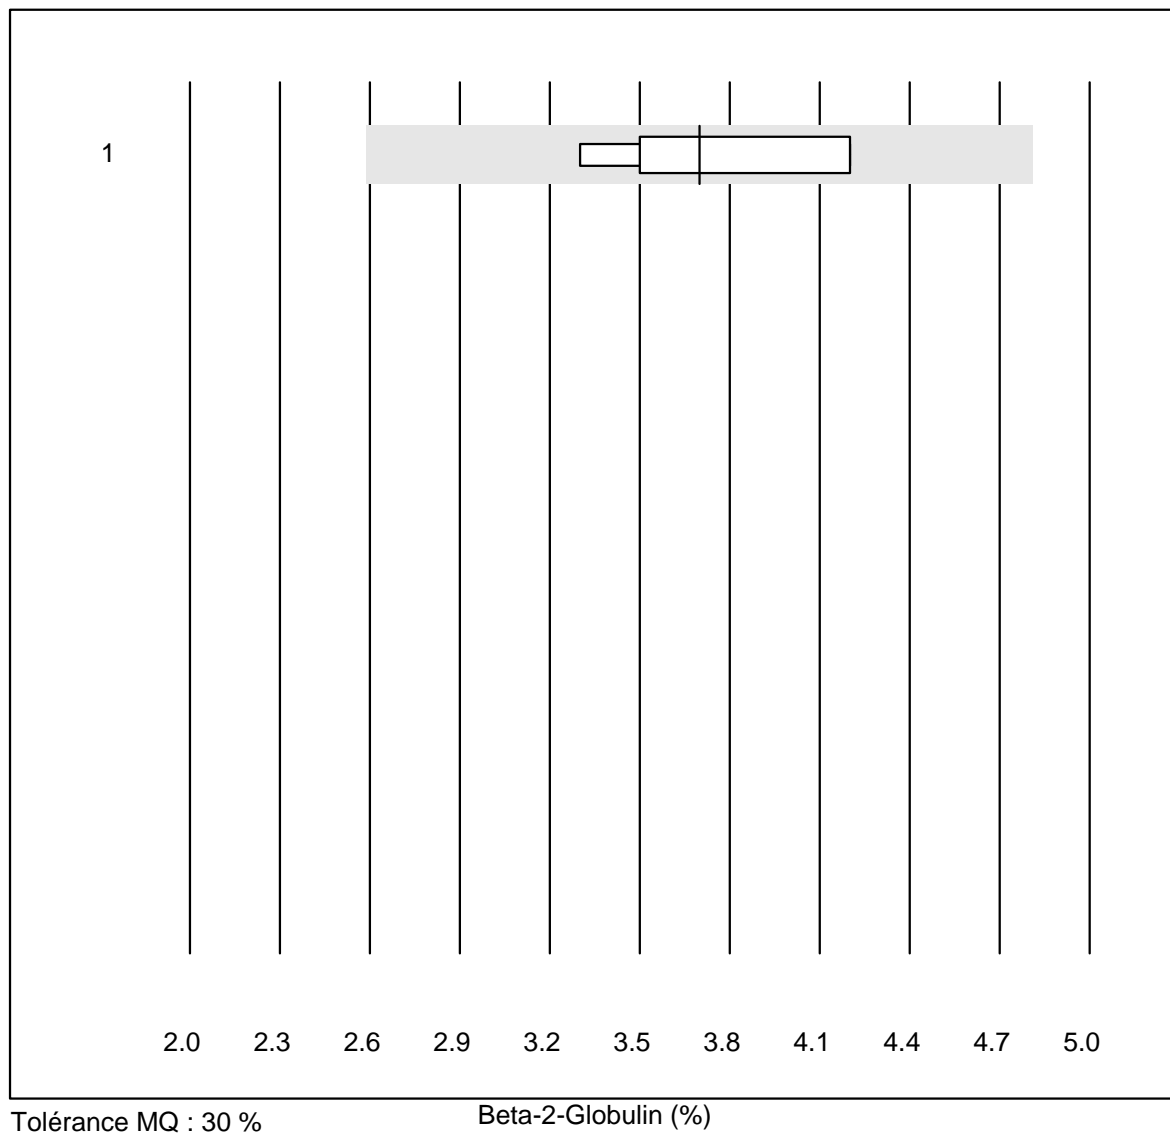


Tolérance MQ : 30 %

Beta-2-Globulin (%)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 électrophorèse	7	100.0	0.0	0.0	3.7	8.9	e

gamma-Globuline

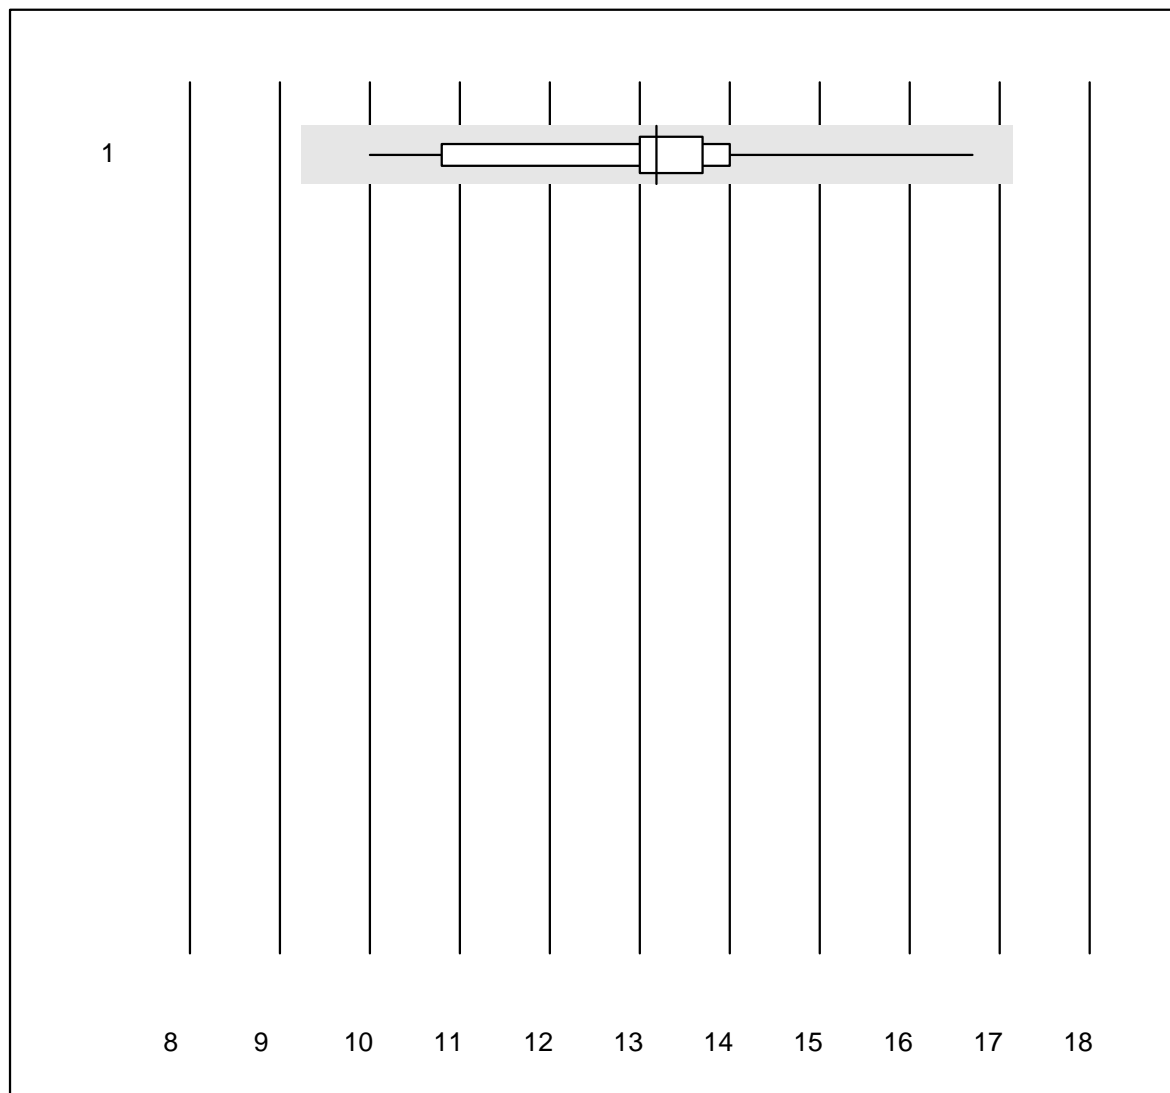


Tolérance MQ : 30 %

gamma-Globuline (%)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 électrophorèse	18	100.0	0.0	0.0	13.2	10.9	e

Gamma-Globuline+P

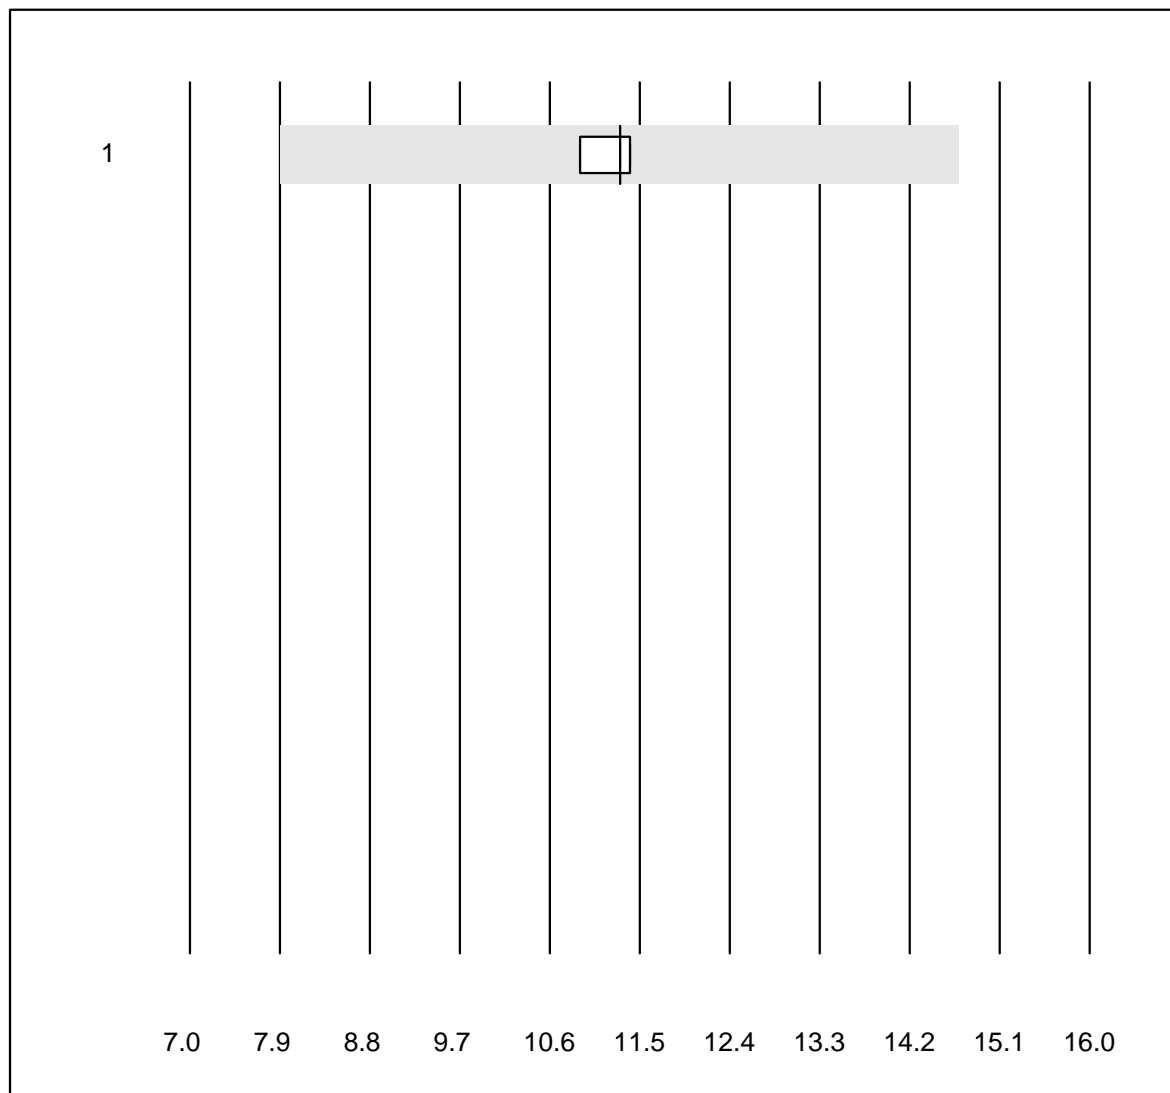


Tolérance MQ : 30 %

Gamma-Globuline+P (%)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 électrophorèse	4	100.0	0.0	0.0	11.3	2.1	e

Immunfixation

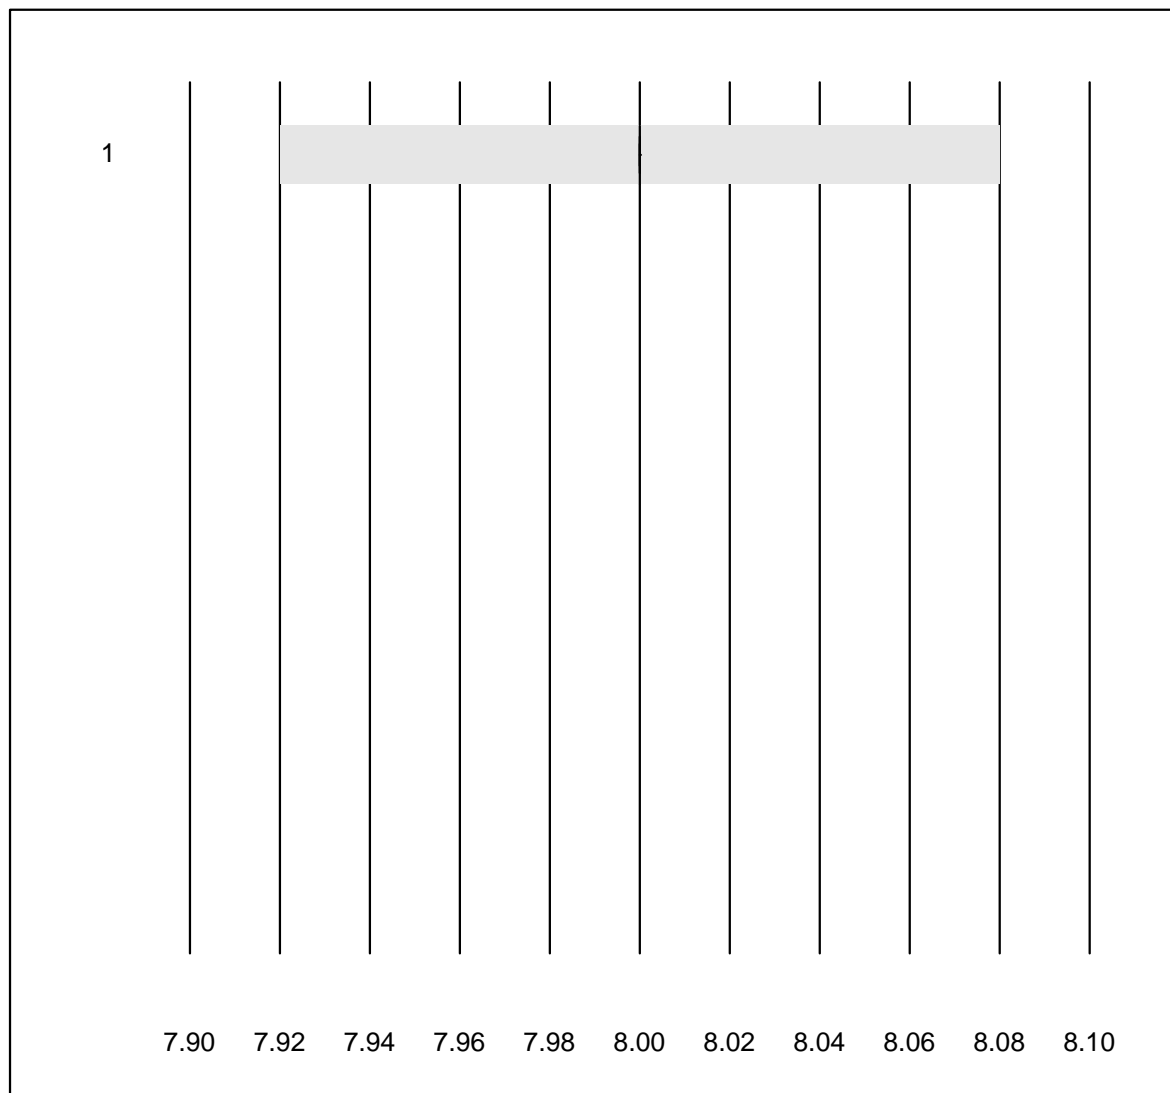


QUALAB Tolérance : 1 %

Immunfixation (Code)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 interprétation	18	88.9	0.0	11.1	8	0.0	e

Folates érythrocytaires

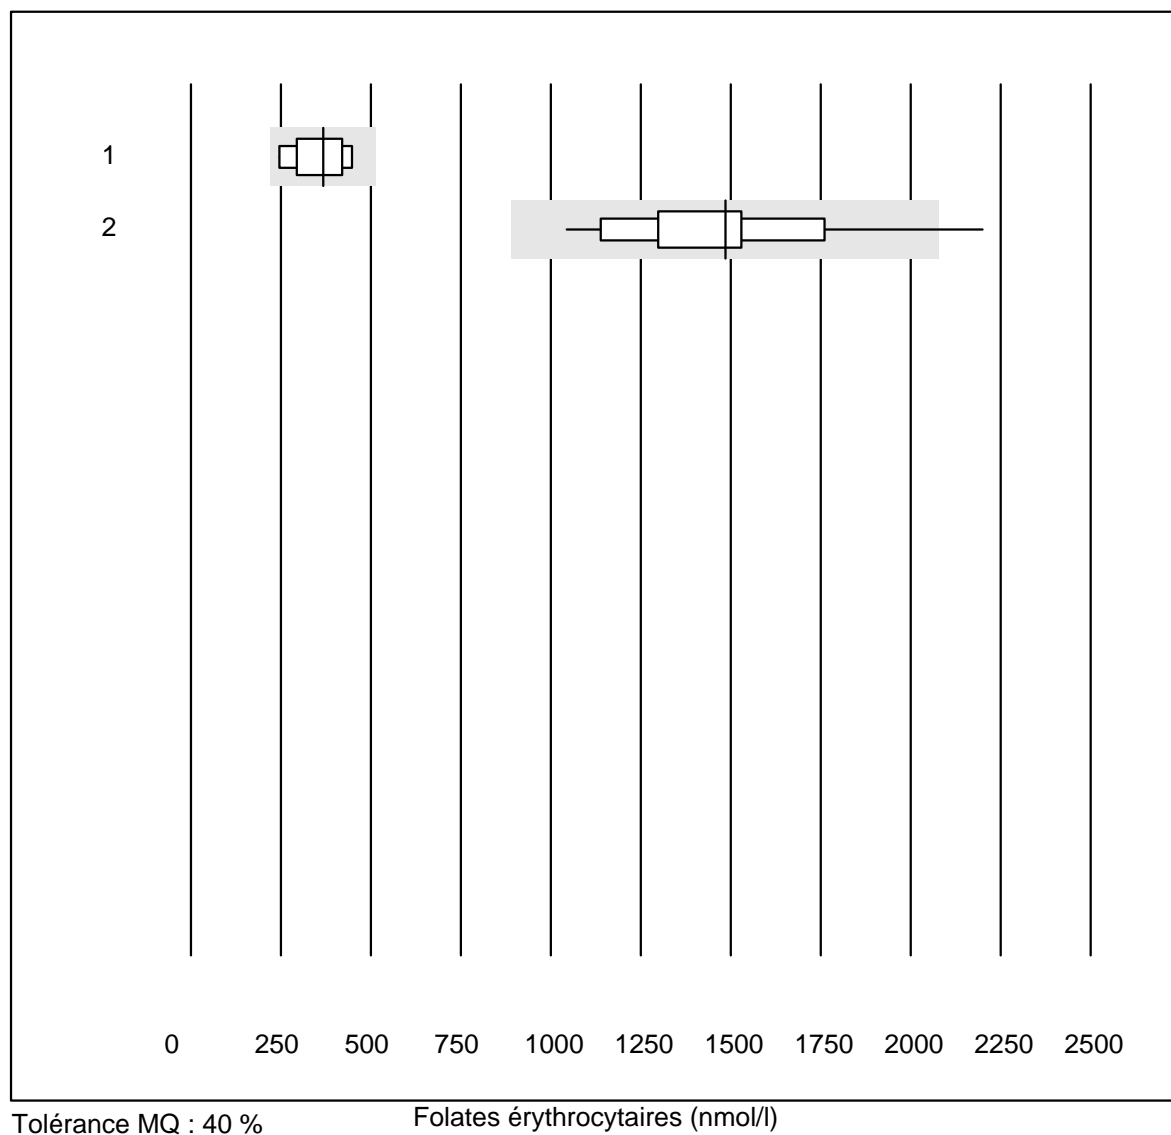


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Architect	7	100.0	0.0	0.0	367	20.6	e*
2 Cobas	14	78.6	7.1	14.3	1486	20.0	e*

Gallensäure

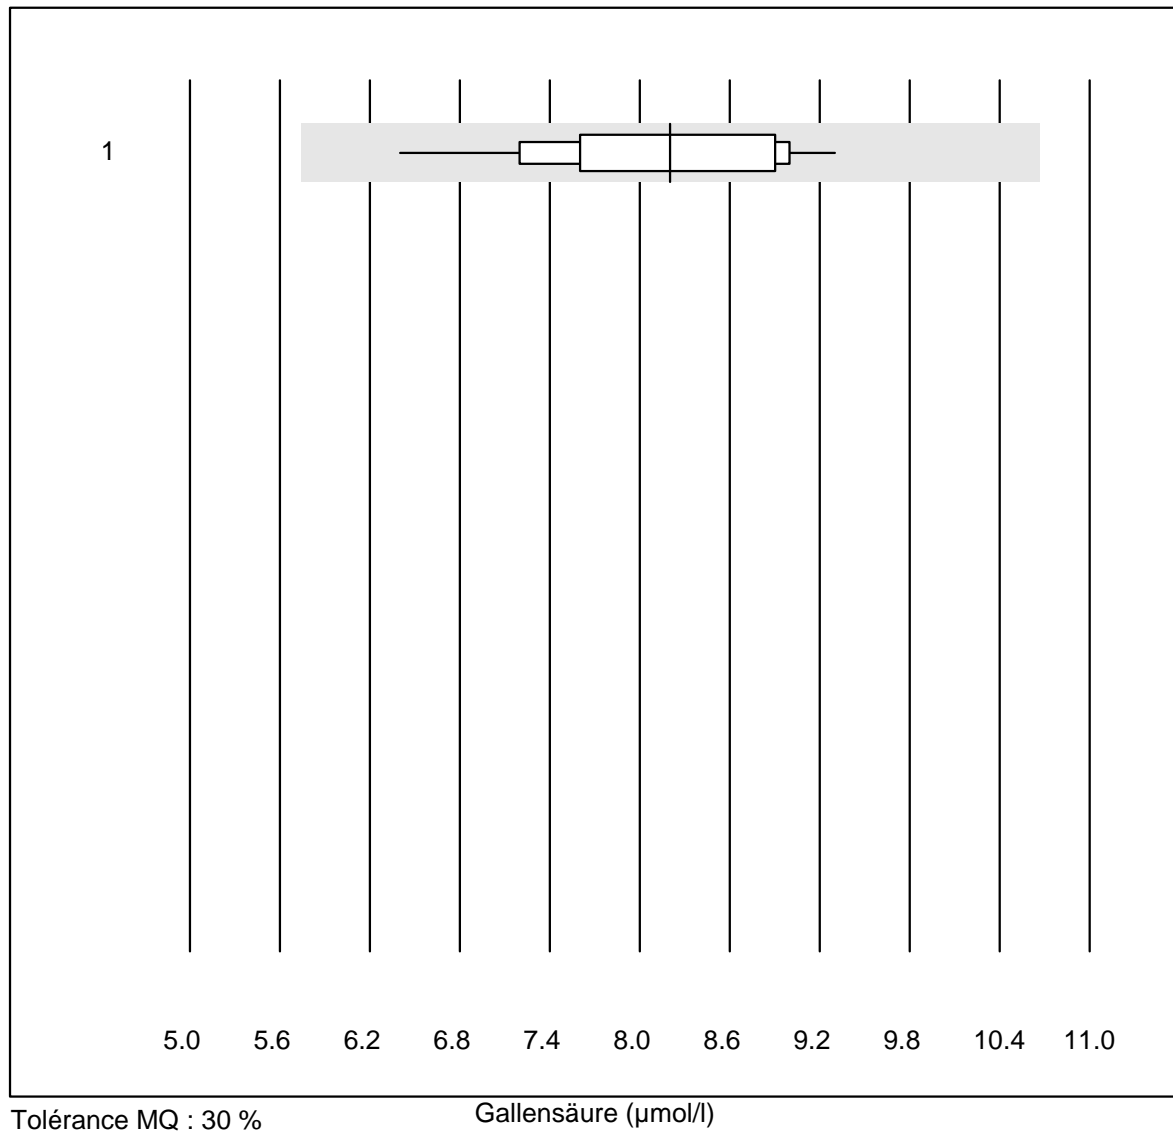

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	21	100.0	0.0	0.0	8.2	9.6	e

BNP

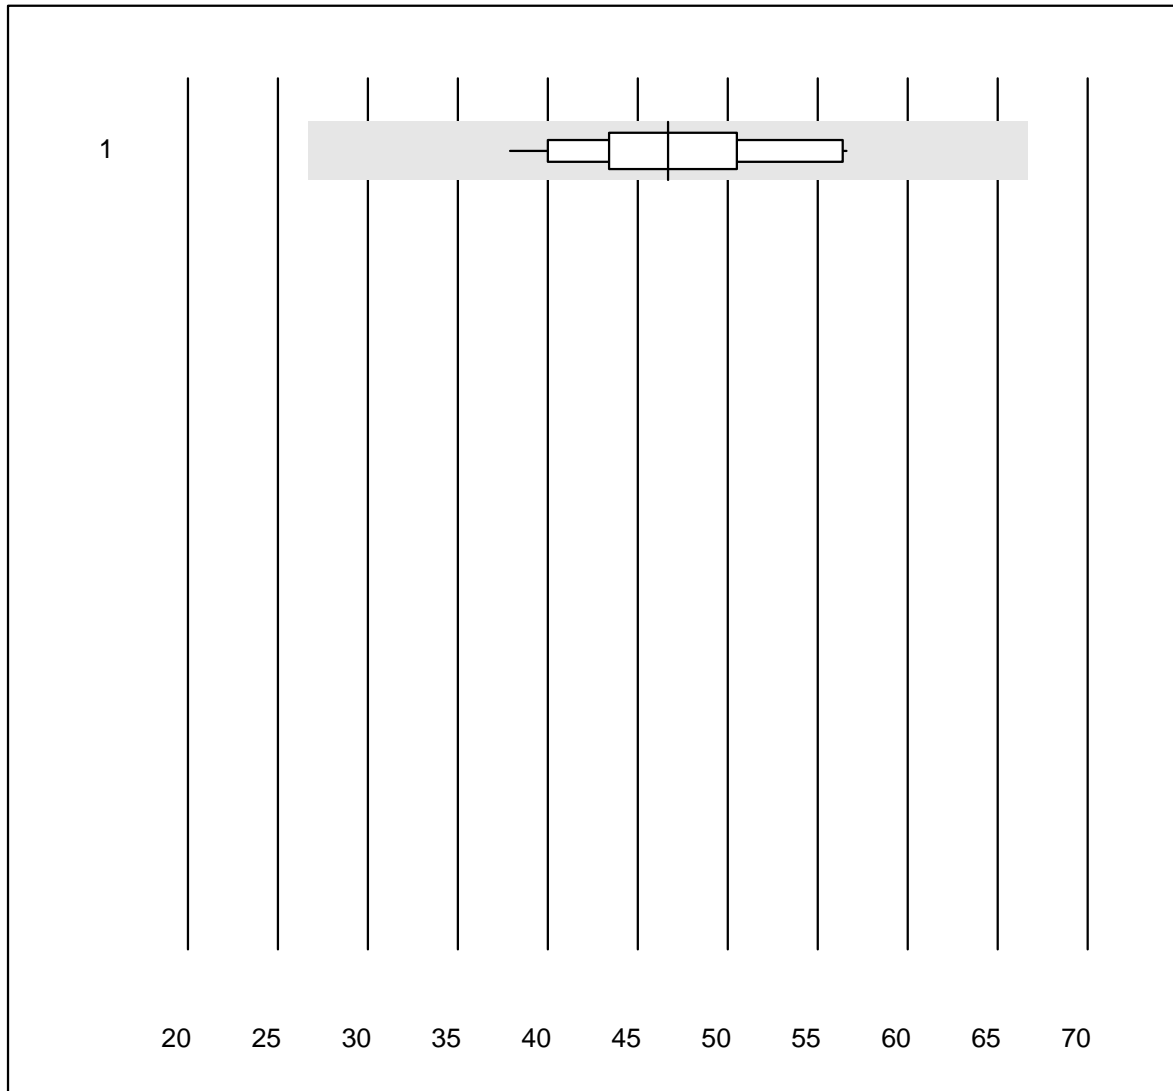


QUALAB Tolérance : 27 %
 (< 75.0: +/- 20.0 ng/l)

BNP (ng/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Triage	16	87.5	0.0	12.5	46.7	12.0	e

Troponin Triage

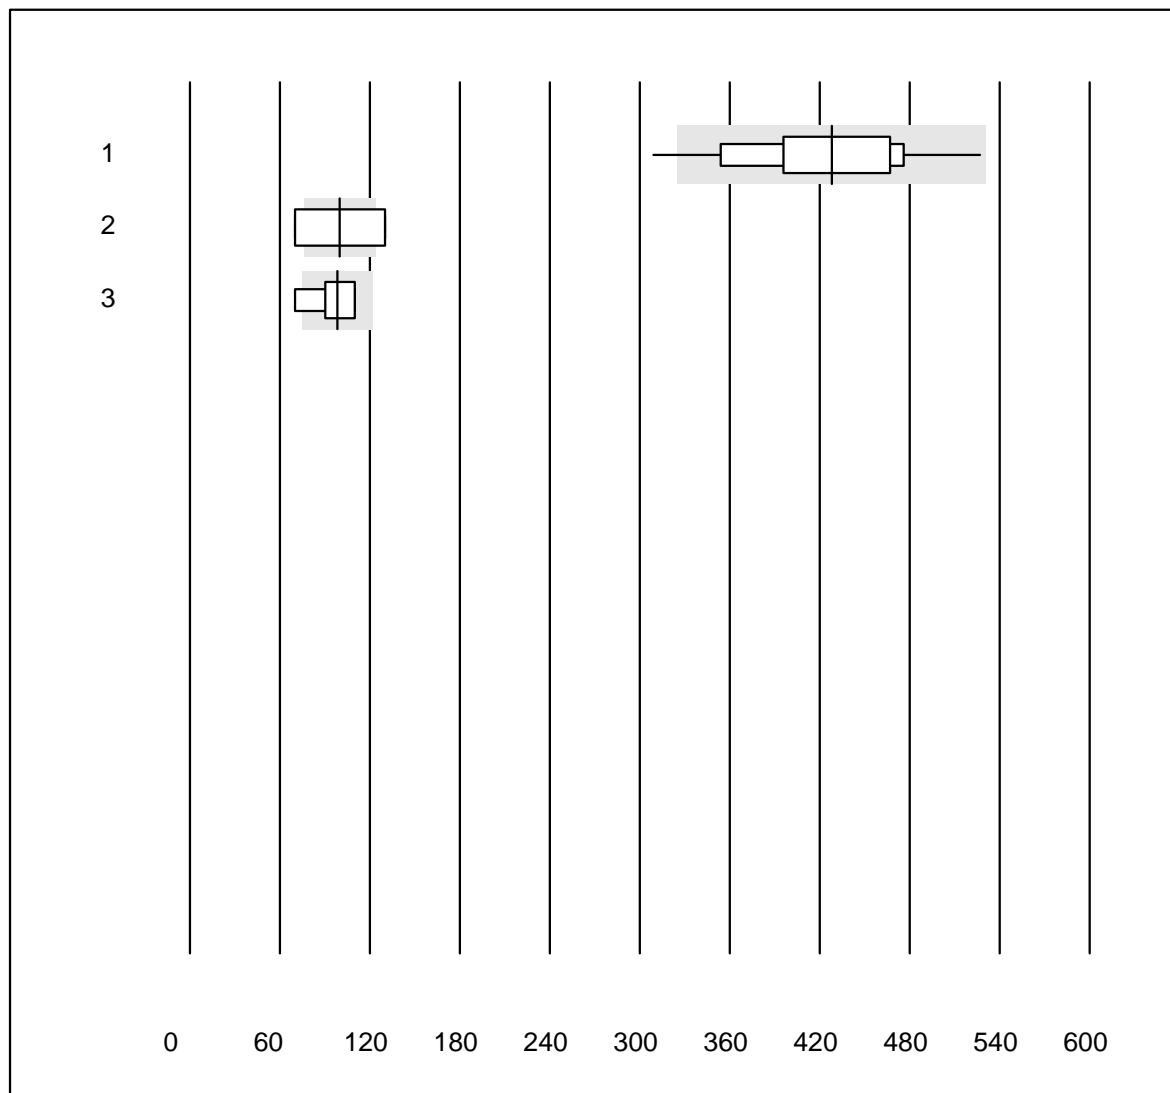


QUALAB Tolérance : 24 %

Troponin Triage (ng/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Triage high sensitiv	30	93.3	6.7	0.0	428.20	11.8	e
2 Triage SOB/Cardiac	4	0.0	50.0	50.0	100.00	42.4	e*
3 Triage Next Gen	10	60.0	10.0	30.0	98.57	16.0	e*

NT-pro BNP

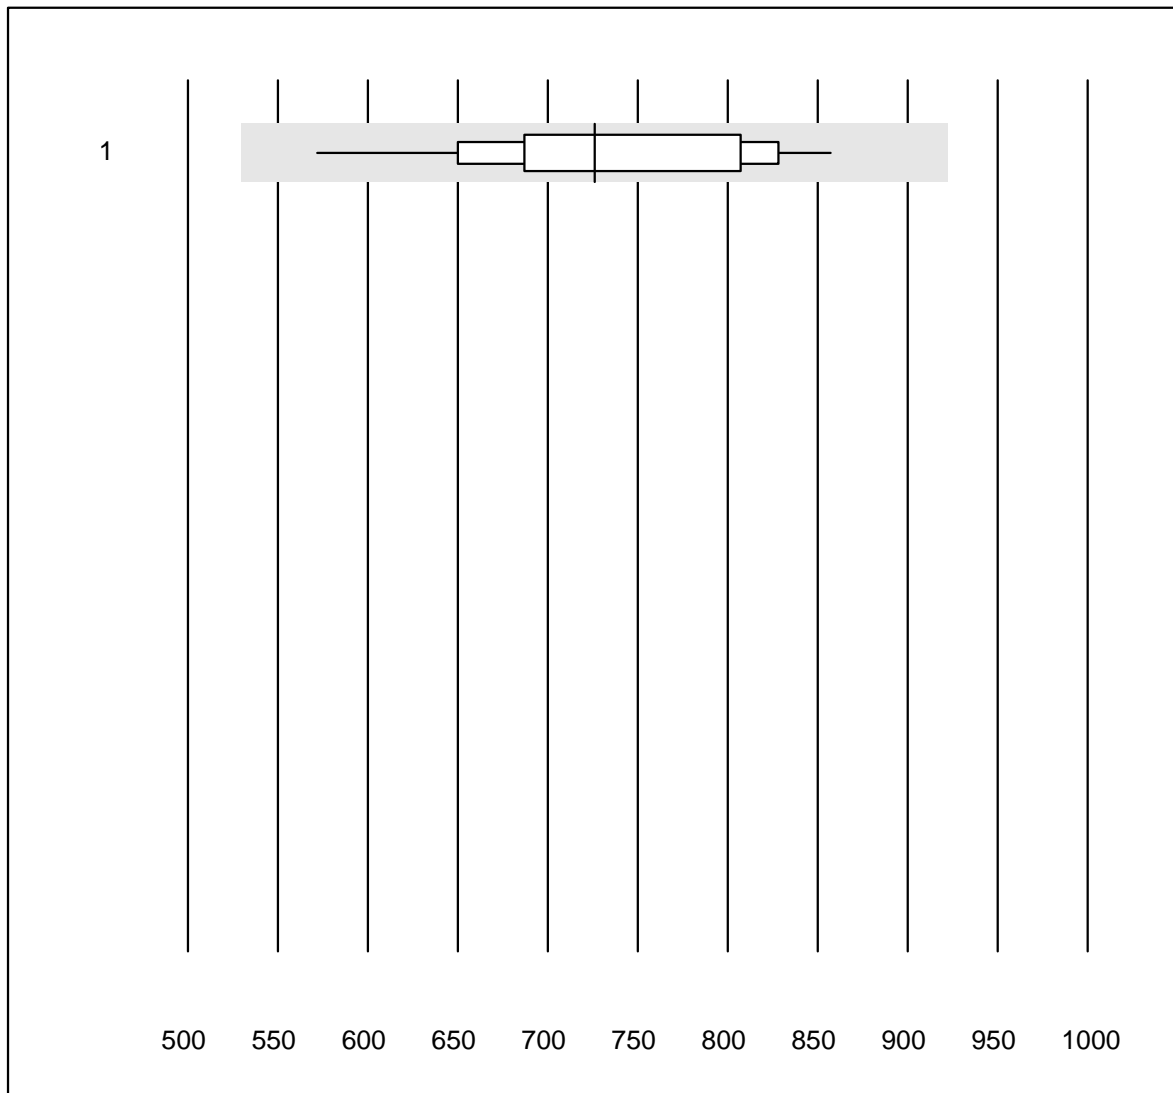


QUALAB Tolérance : 27 %

NT-pro BNP (ng/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Triage	14	92.9	0.0	7.1	726	11.4	e

D-Dimere Triage

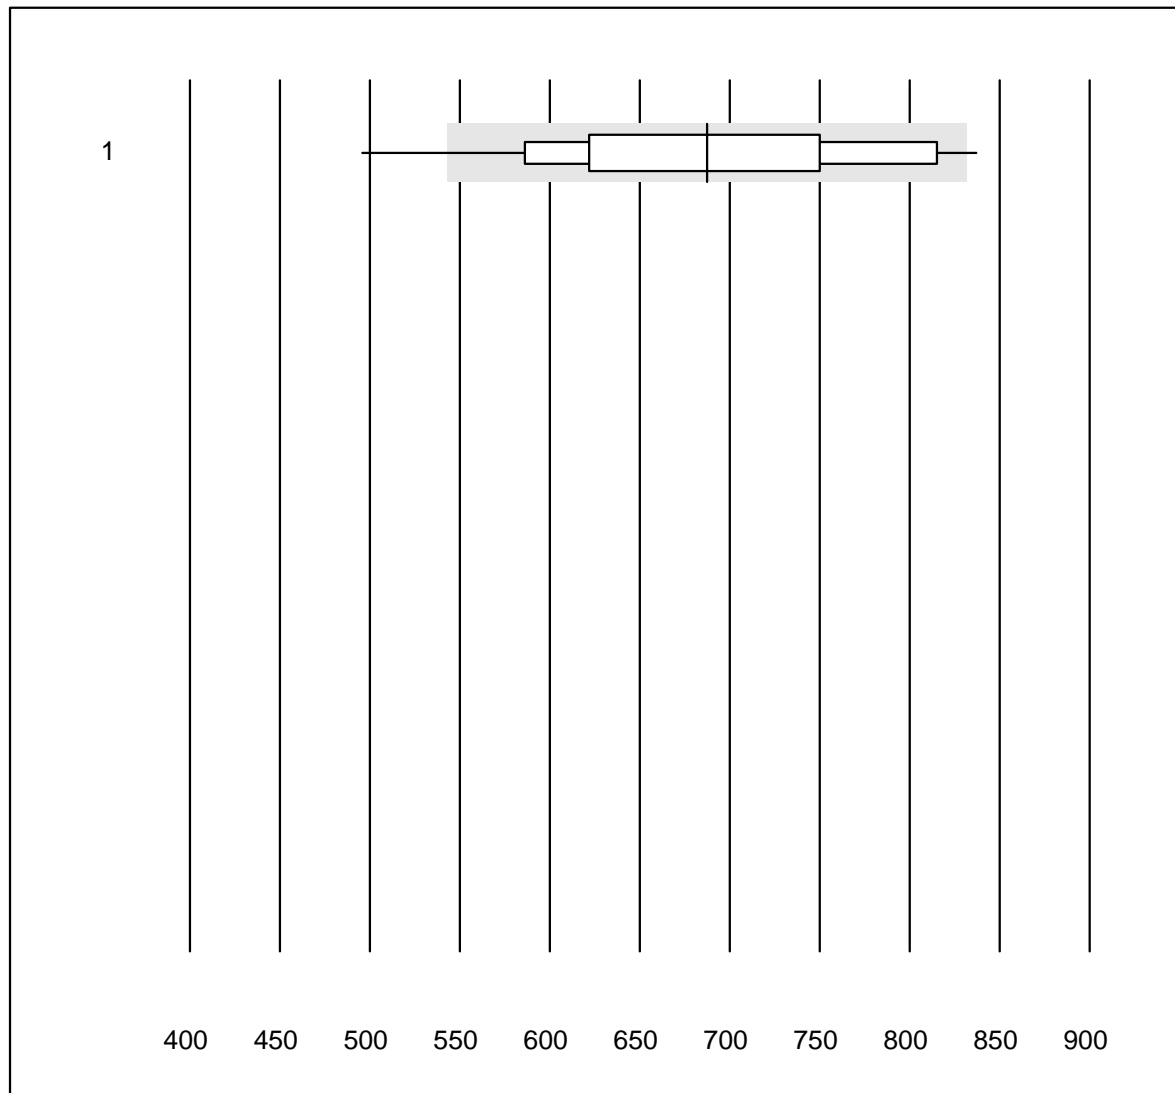


QUALAB Tolérance : 21 %

D-Dimere Triage (ng/ml)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Triage	38	84.2	7.9	7.9	687.57	12.7	e

Vitamine D 25 (OH)

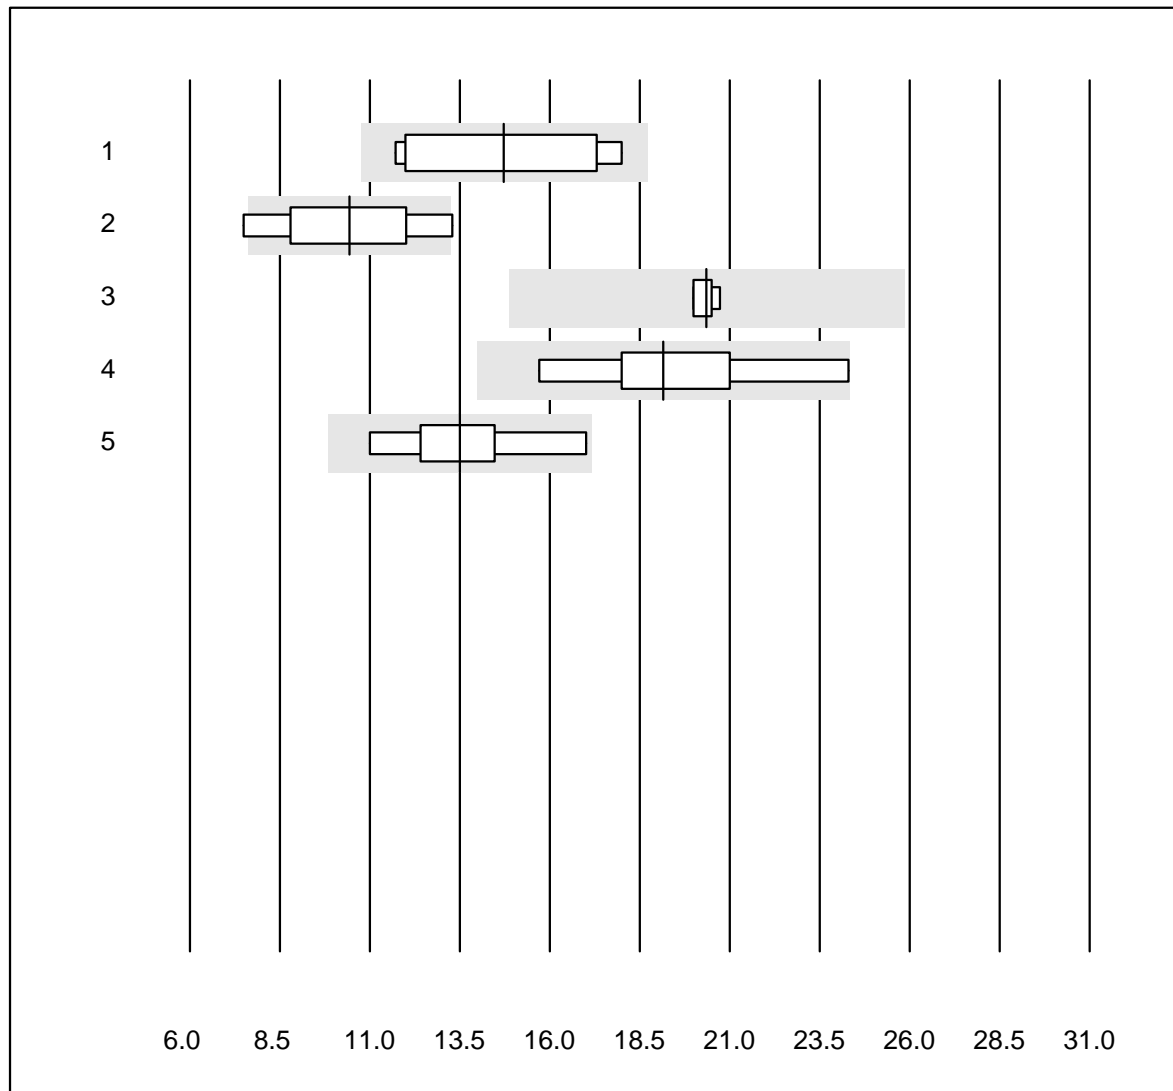


QUALAB Tolérance : 27 %

Vitamine D 25 (OH) (nmol/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 LCMS	5	100.0	0.0	0.0	14.7	19.8	e*
2 Cobas	13	53.8	15.4	30.8	10.4	19.9	e*
3 VIDAS	6	83.3	0.0	16.7	20.4	1.6	e
4 Autres méthodes	13	46.2	0.0	53.8	19.2	15.0	a
5 Architect	9	100.0	0.0	0.0	13.5	13.1	e*

AMH

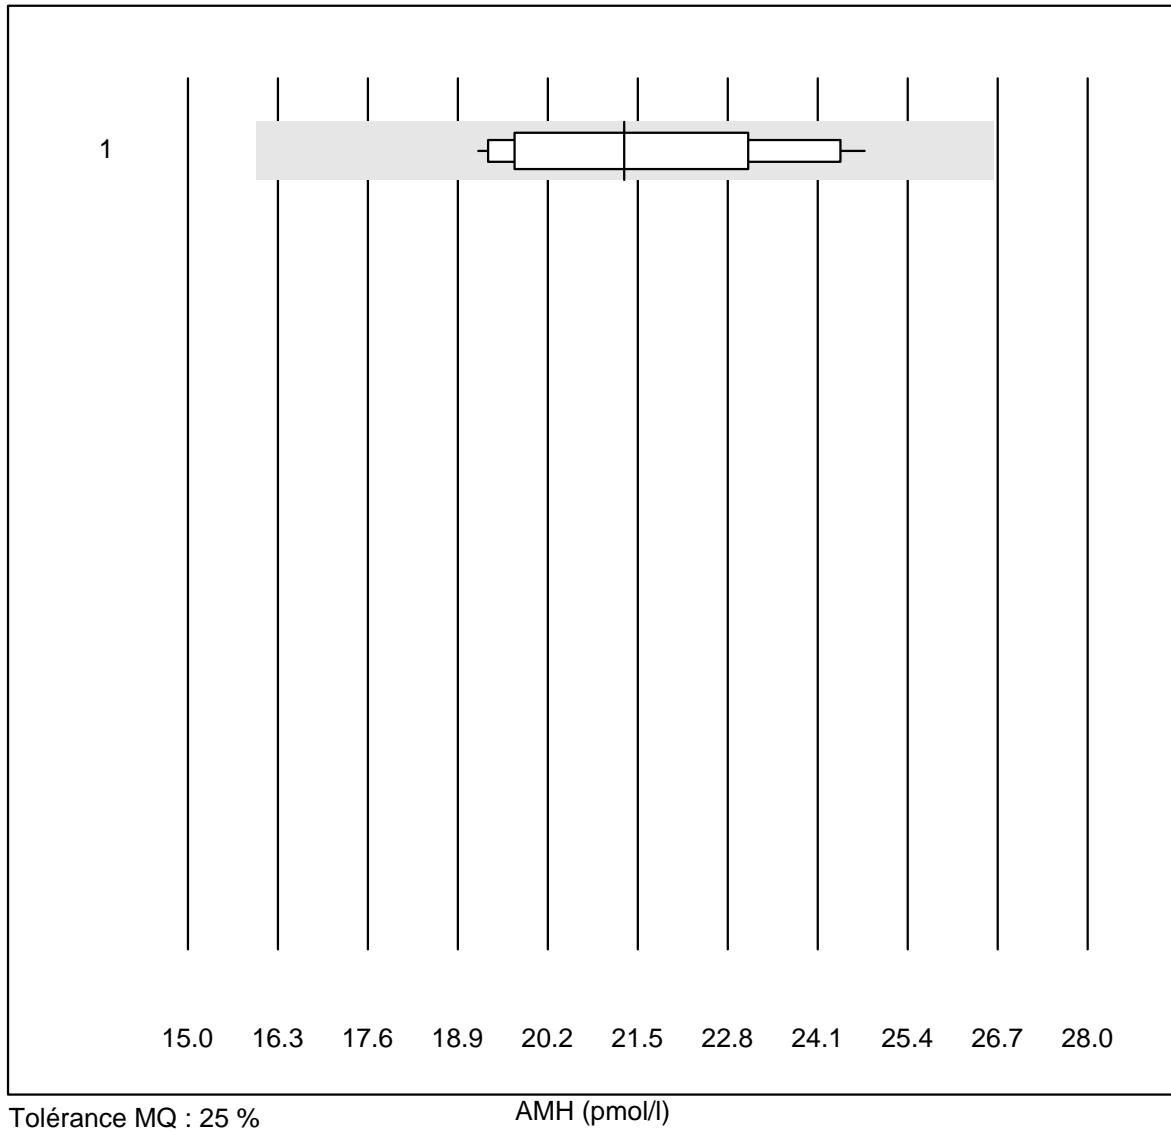

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	11	100.0	0.0	0.0	21.3	9.5	e

Inhibin B

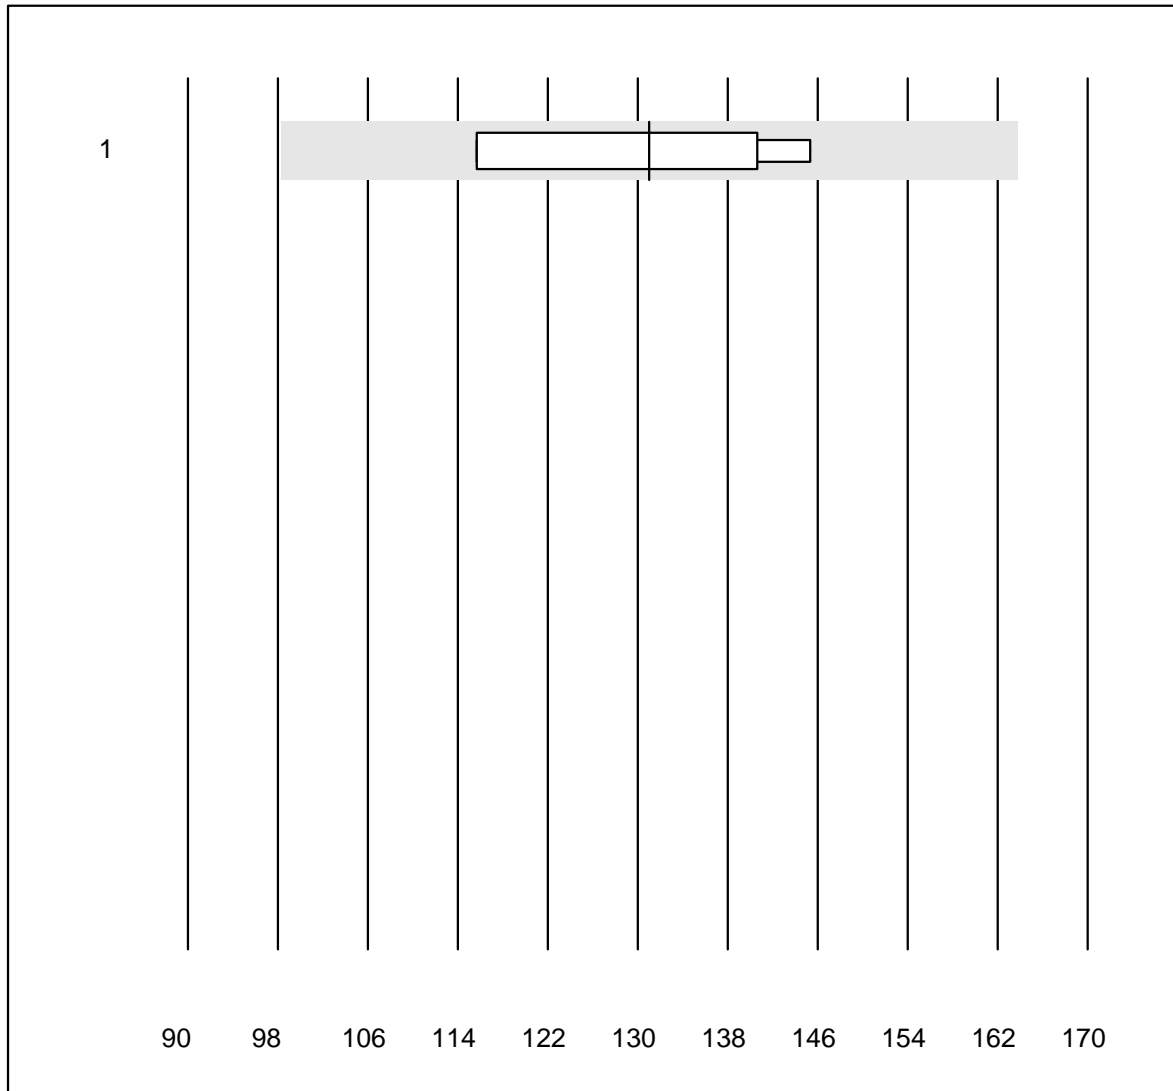


Tolérance MQ : 25 %

Inhibin B (ng/l)


No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	131	11.0	e*

Calcitonin

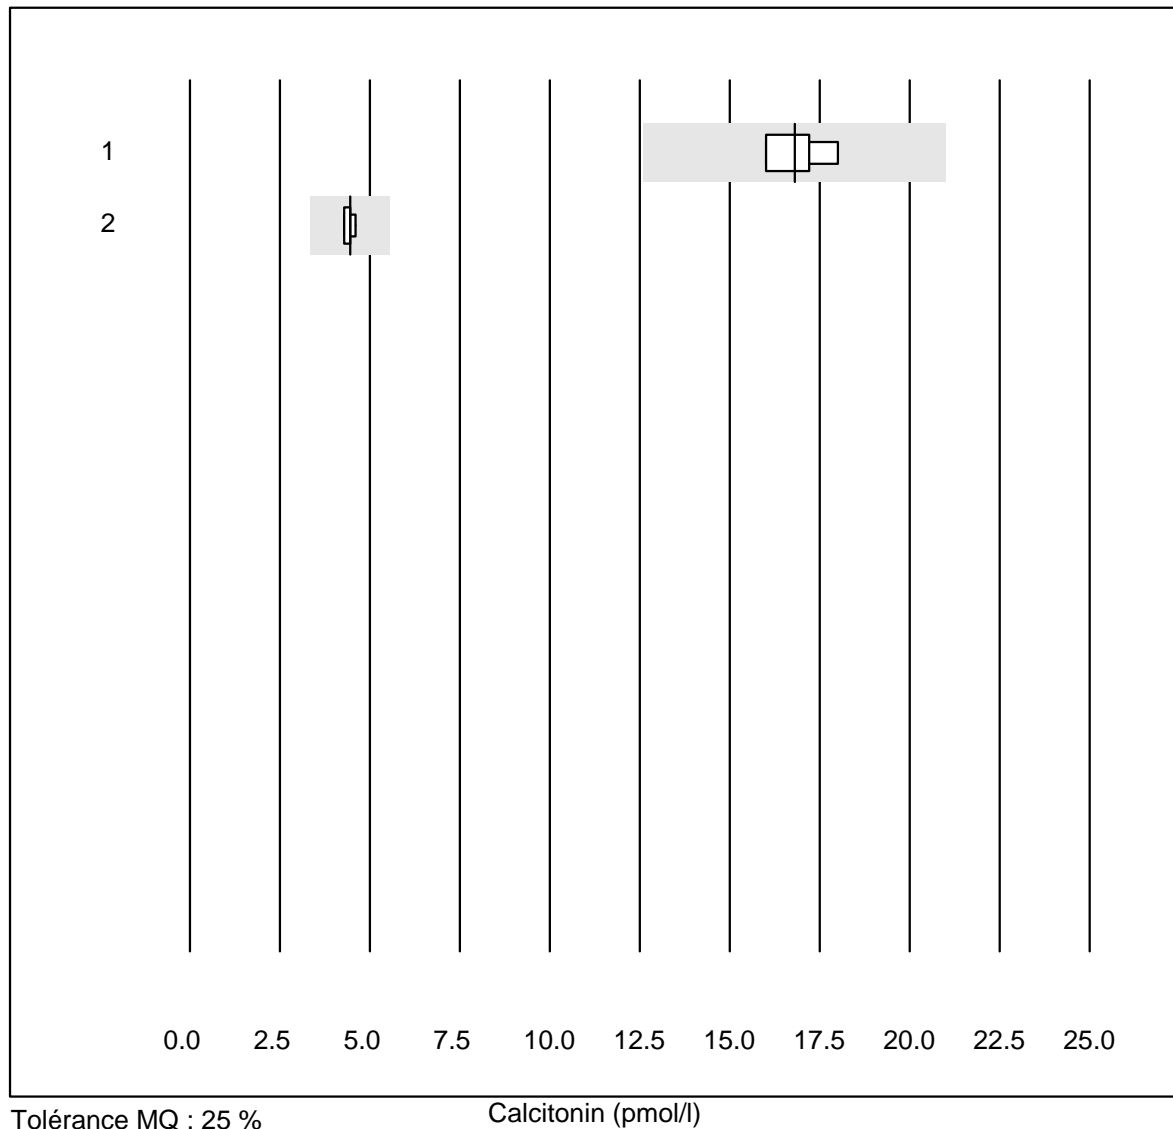


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	16.8	5.2	e
2 Liaison	4	100.0	0.0	0.0	4.4	3.0	e

Anti Thyreoglobulin

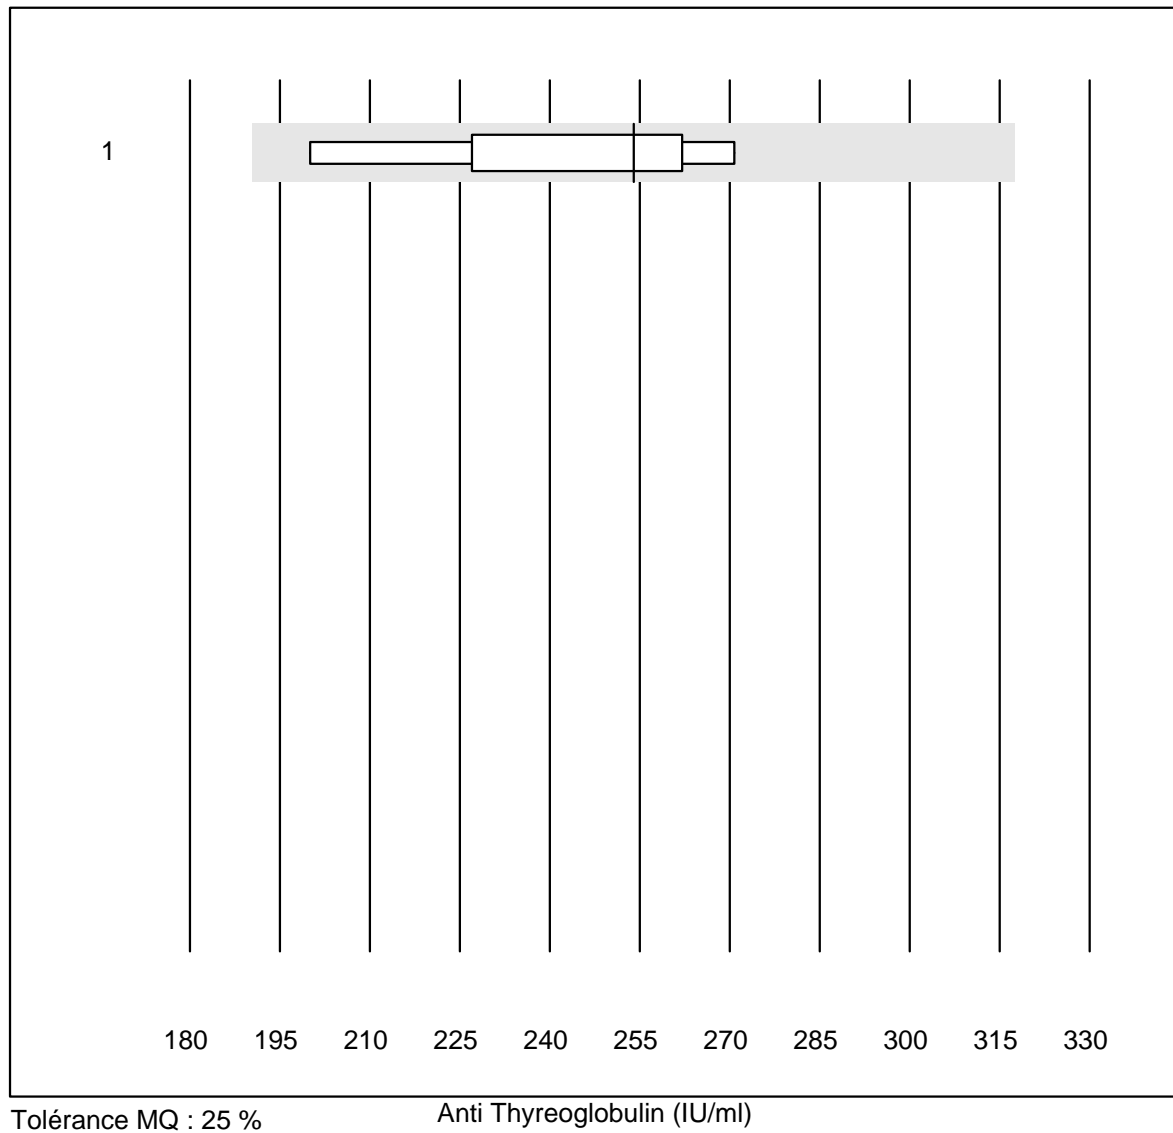


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	7	100.0	0.0	0.0	254	10.0	e*

Anti TPO

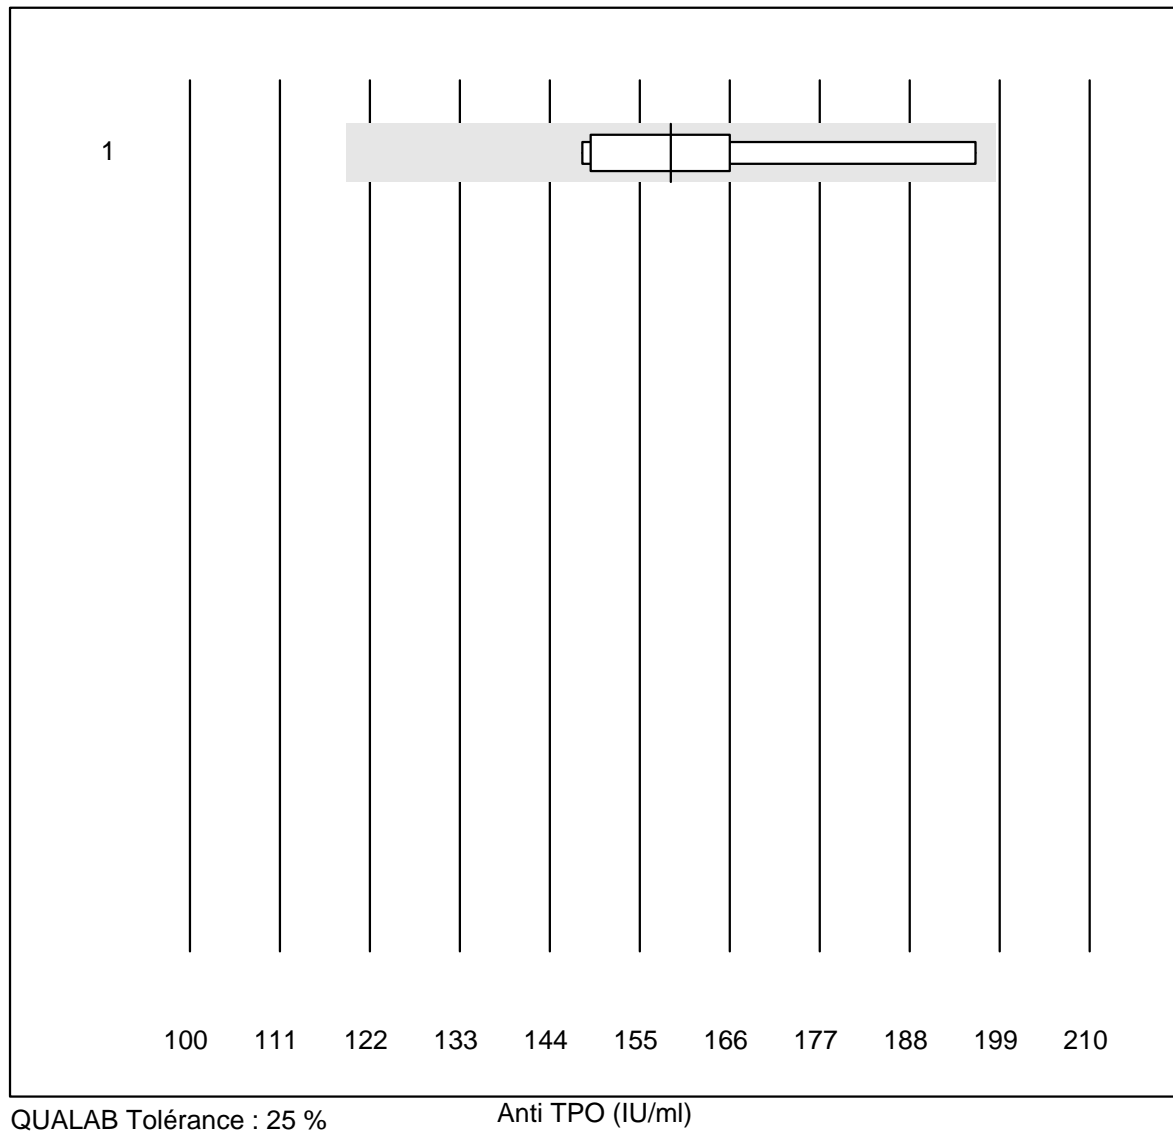


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	8	100.0	0.0	0.0	159	9.8	e*

TRAK

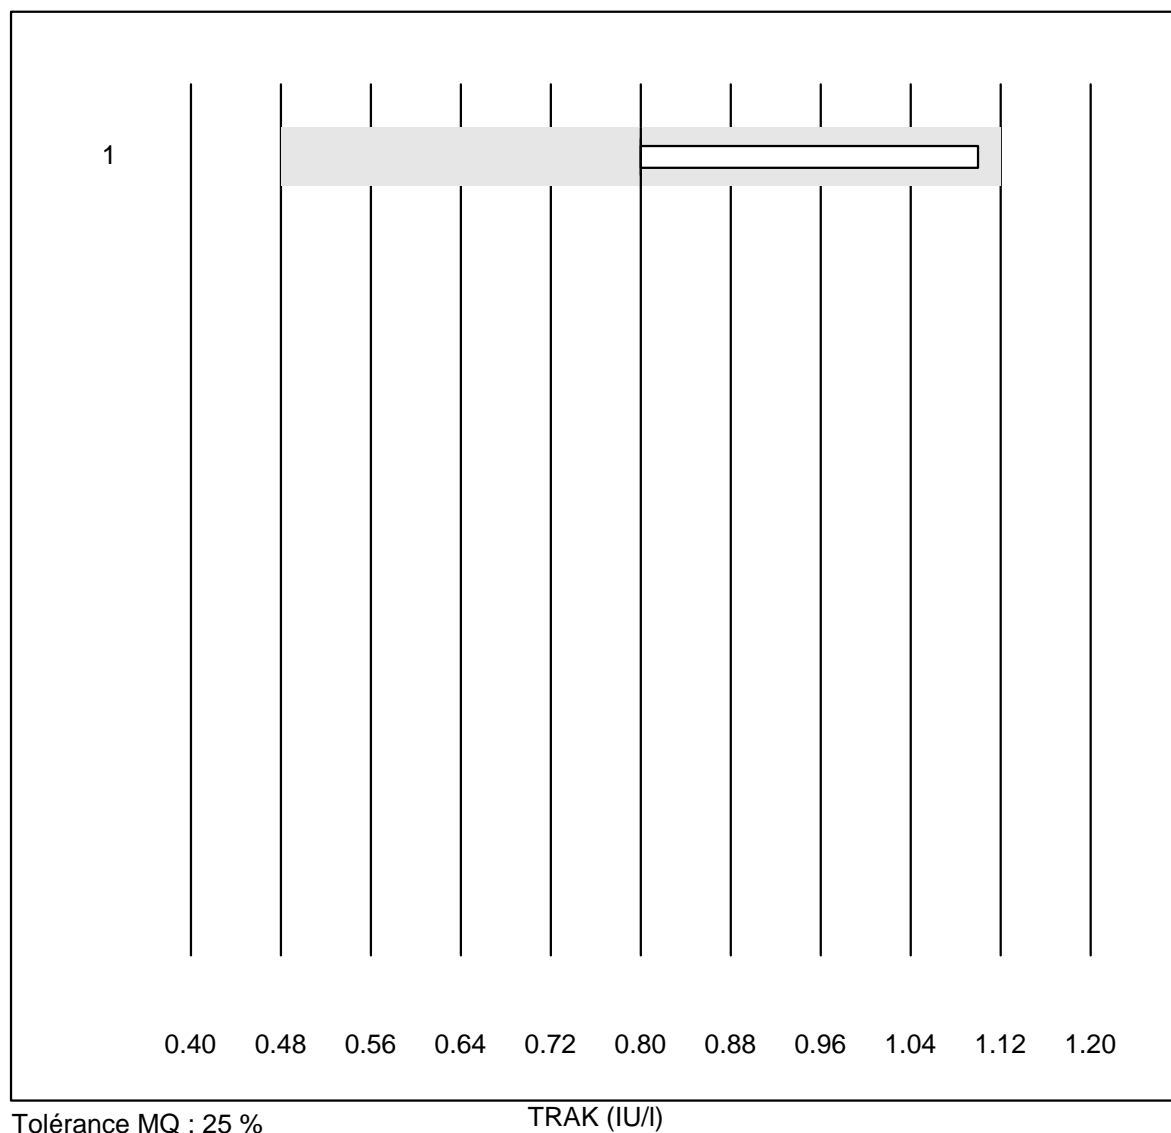

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	6	100.0	0.0	0.0	0.80	14.4	a

Créatinine WB

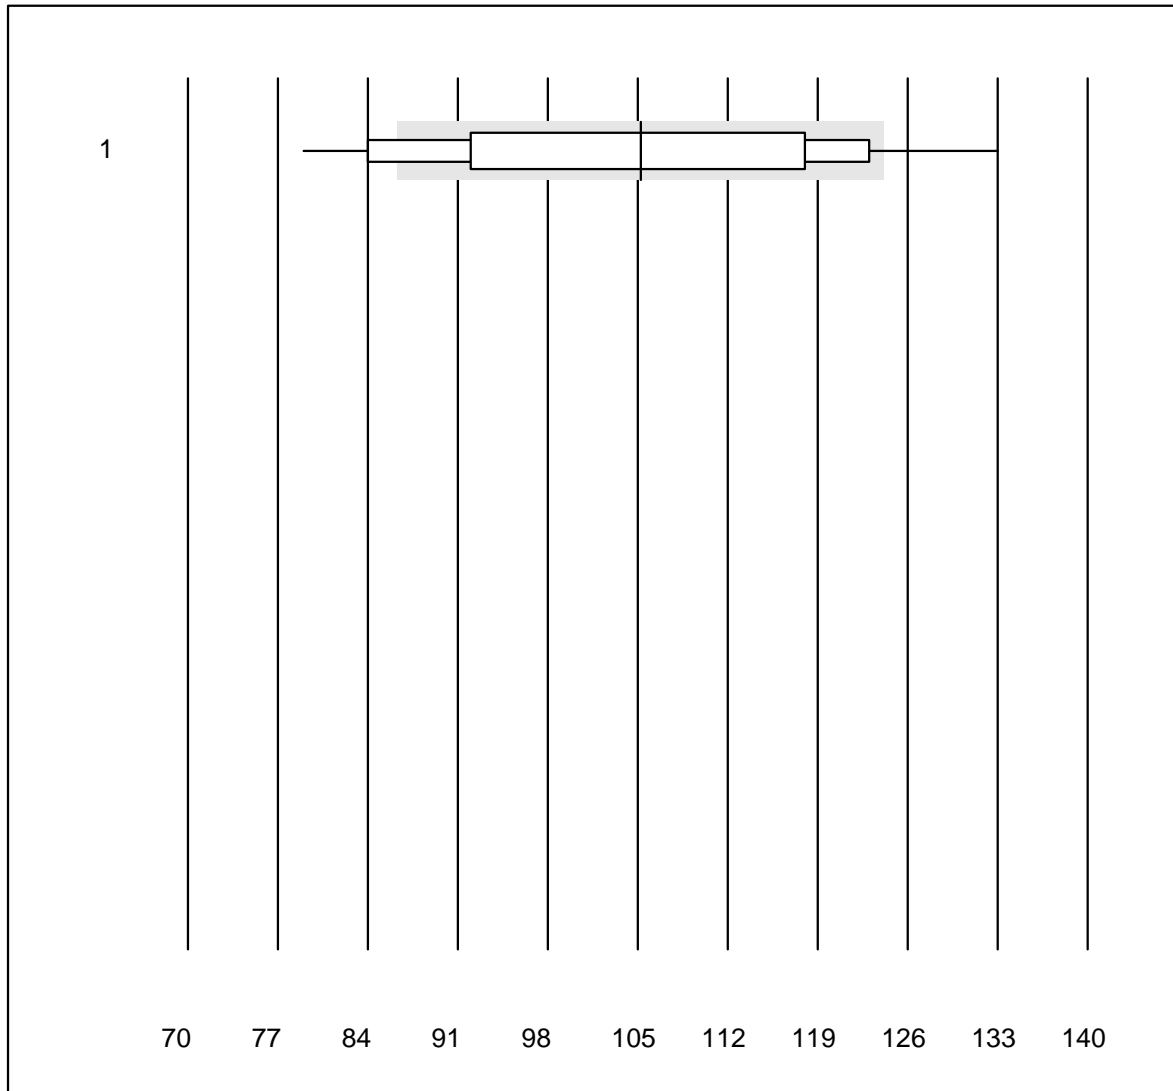


QUALAB Tolérance : 18 %

Créatinine WB (µmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Statsensor i / Nova	47	70.3	19.1	10.6	105	14.5	e

IL6

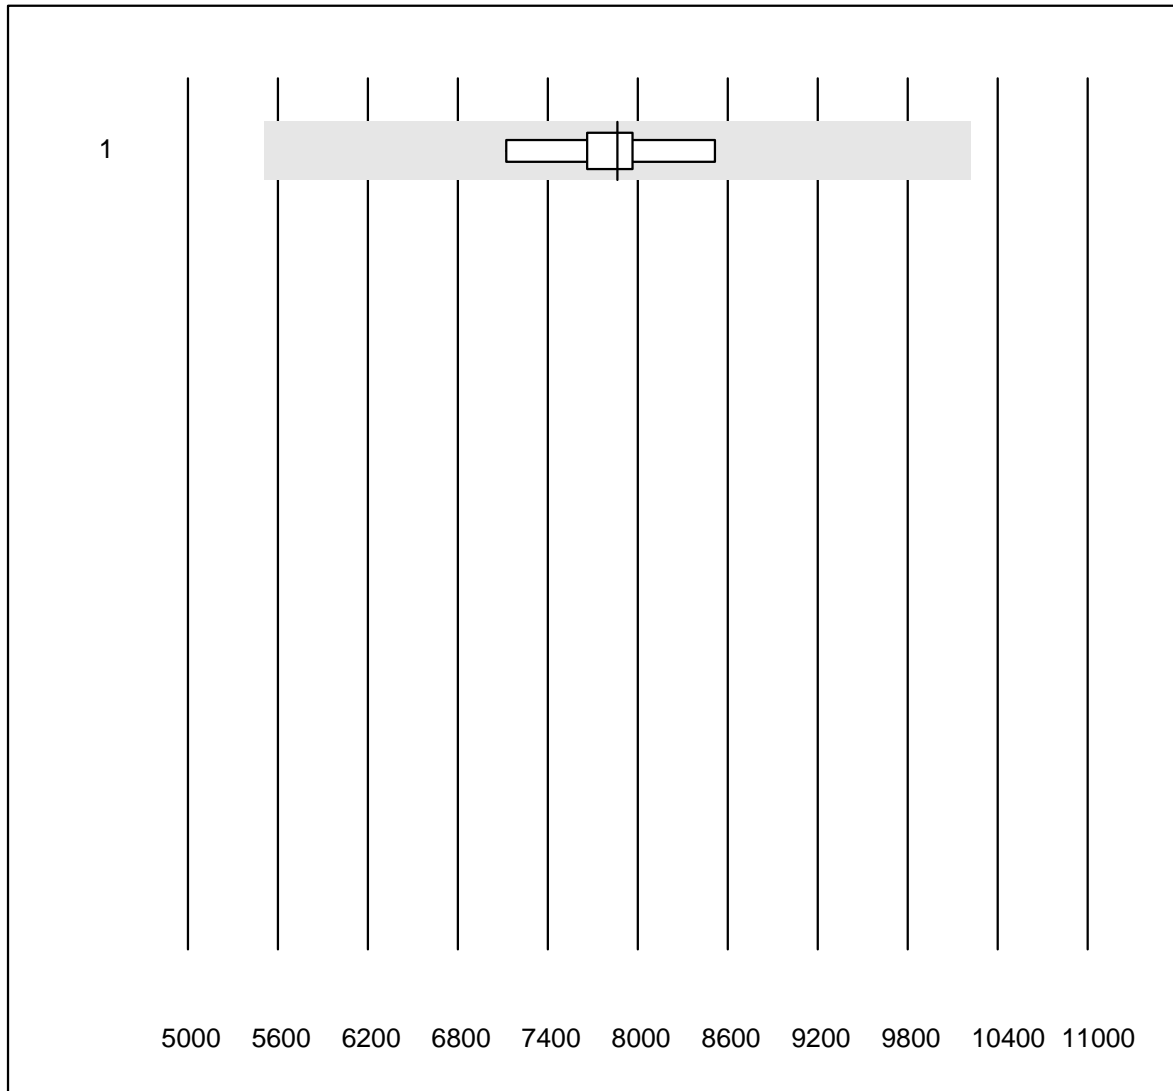


Tolérance MQ : 30 %

IL6 (ng/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	7862.0	6.4	e

D-Dimere qn

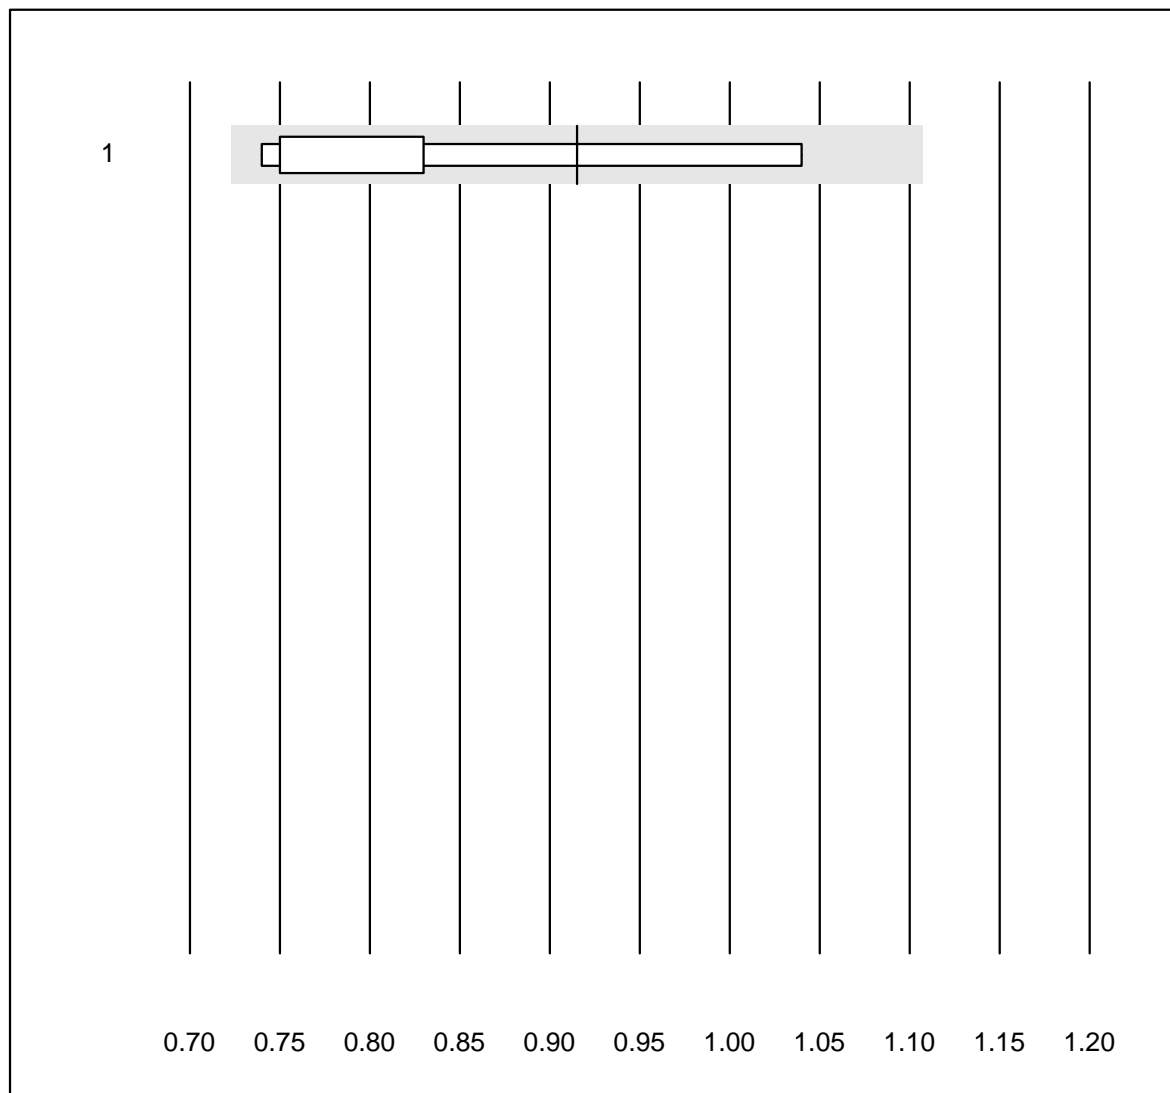


QUALAB Tolérance : 0 %

D-Dimere qn (mg/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Exdia TRF	8	62.5	0.0	37.5	0.92	15.1	a

Troponin I qn

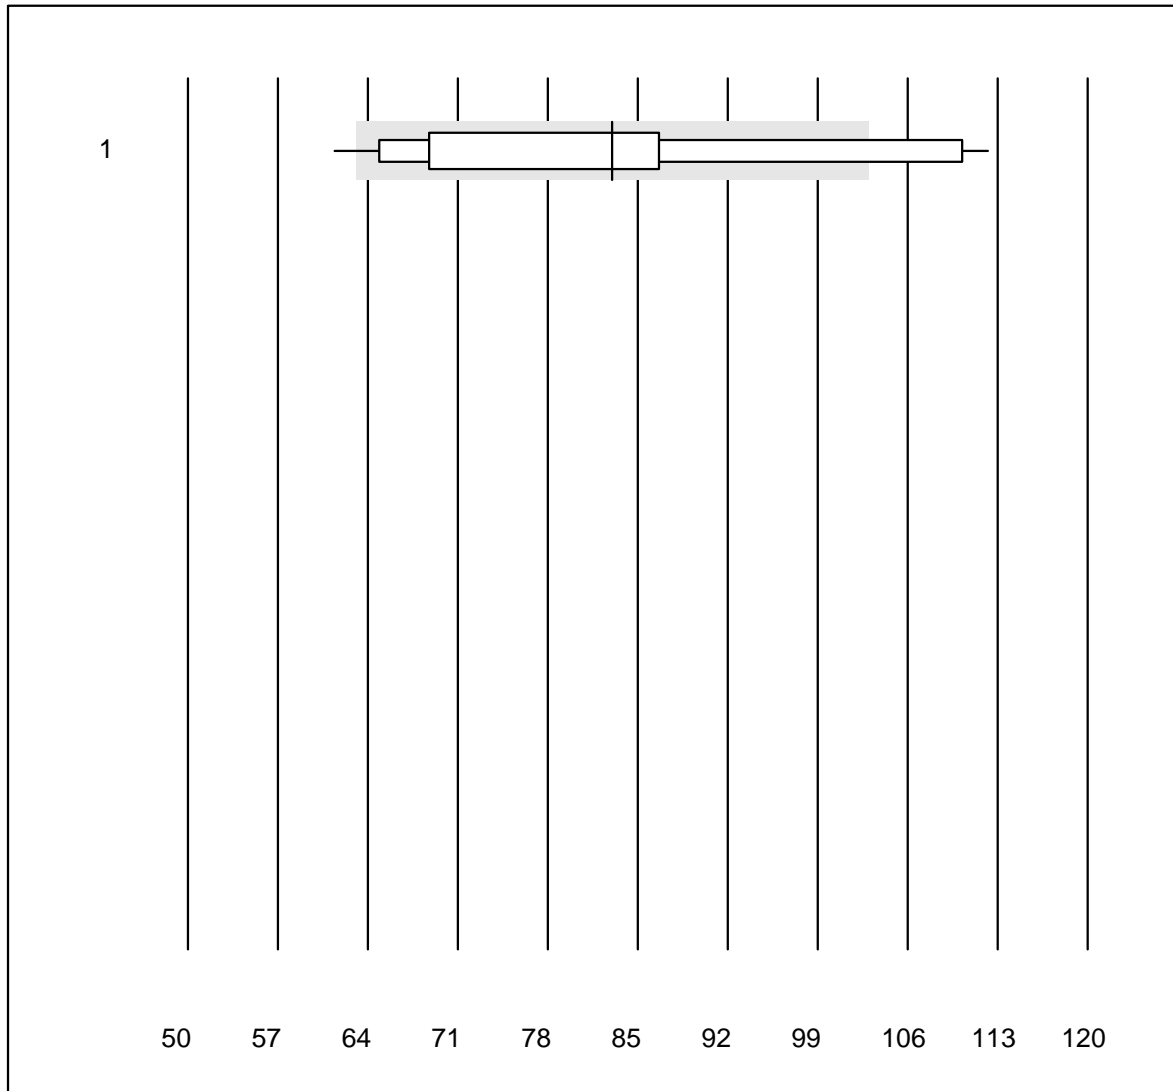


QUALAB Tolérance : 0 %

Troponin I qn (ng/l)


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Exdia TRF	24	62.5	12.5	25.0	83.00	19.1	a

proBNP

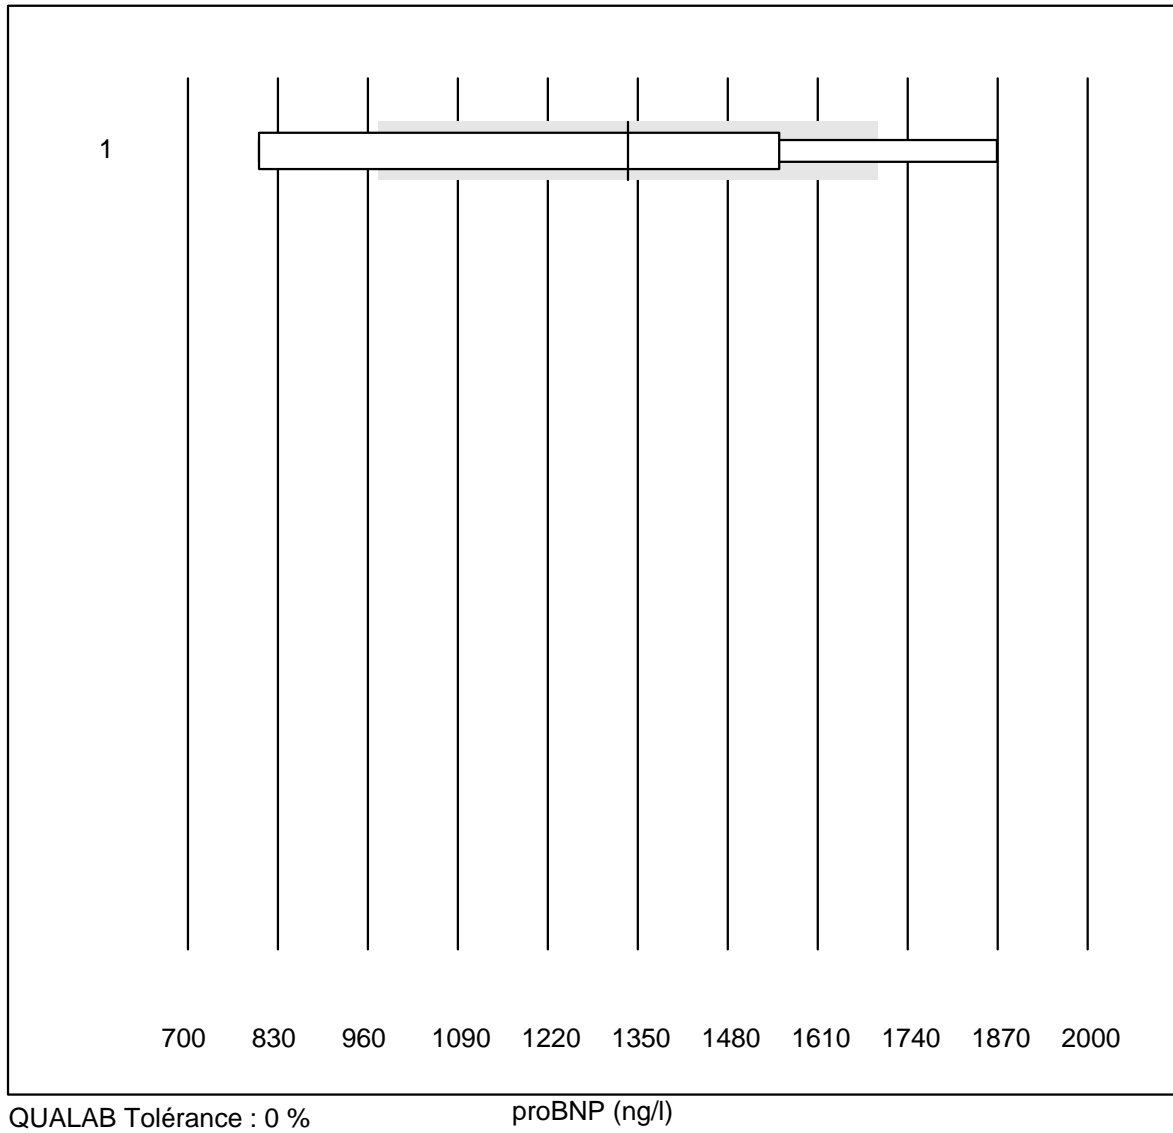

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Exdia TRF	8	25.0	25.0	50.0	1336.0	35.2	a

Calcium-urine

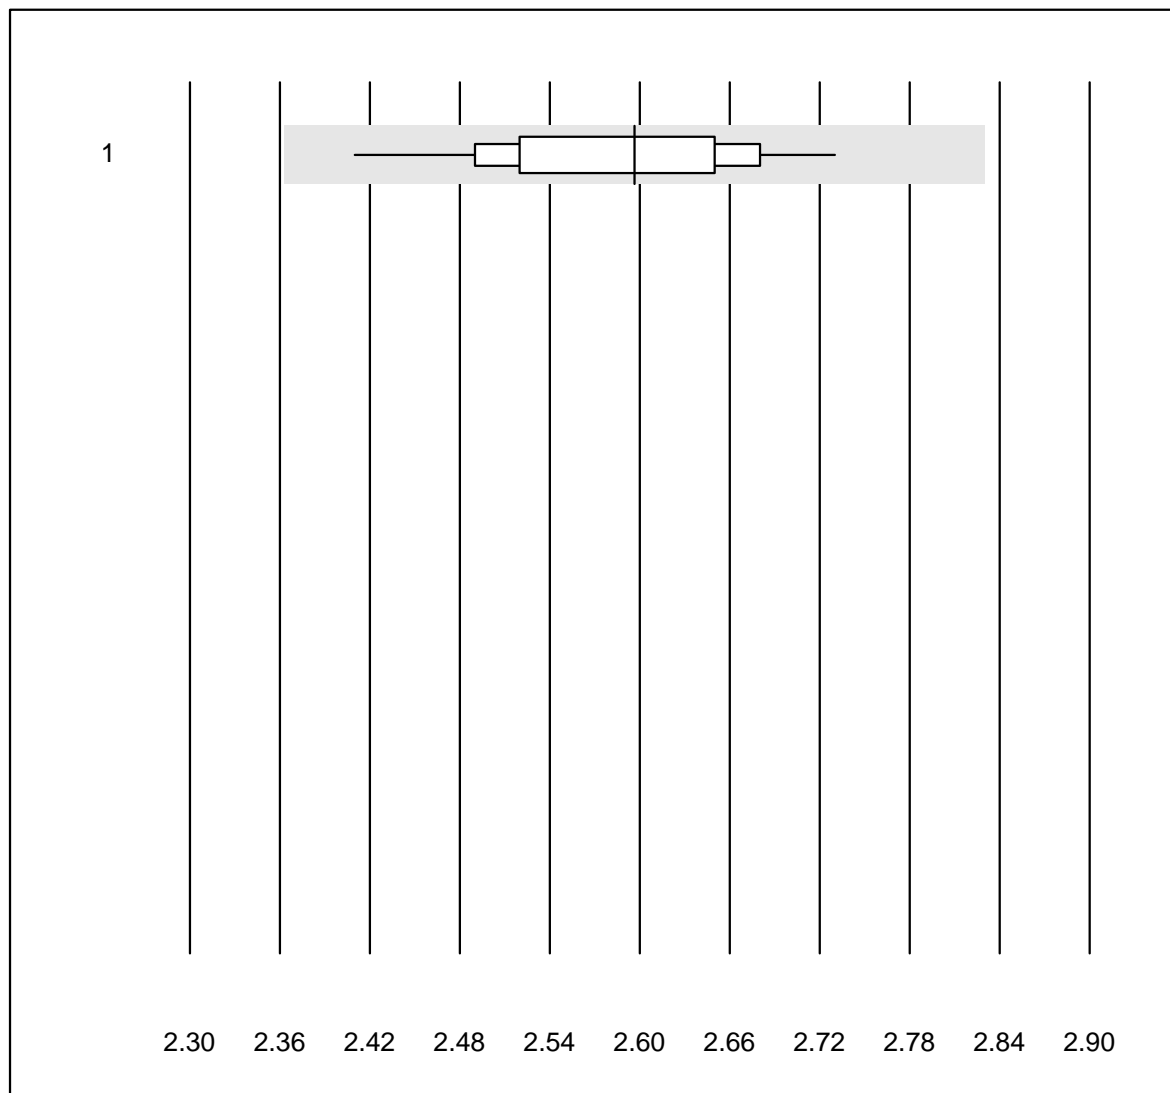


Tolérance MQ : 9 %

Calcium-urine (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	20	100.0	0.0	0.0	2.60	3.1	e

Chlorures-urine

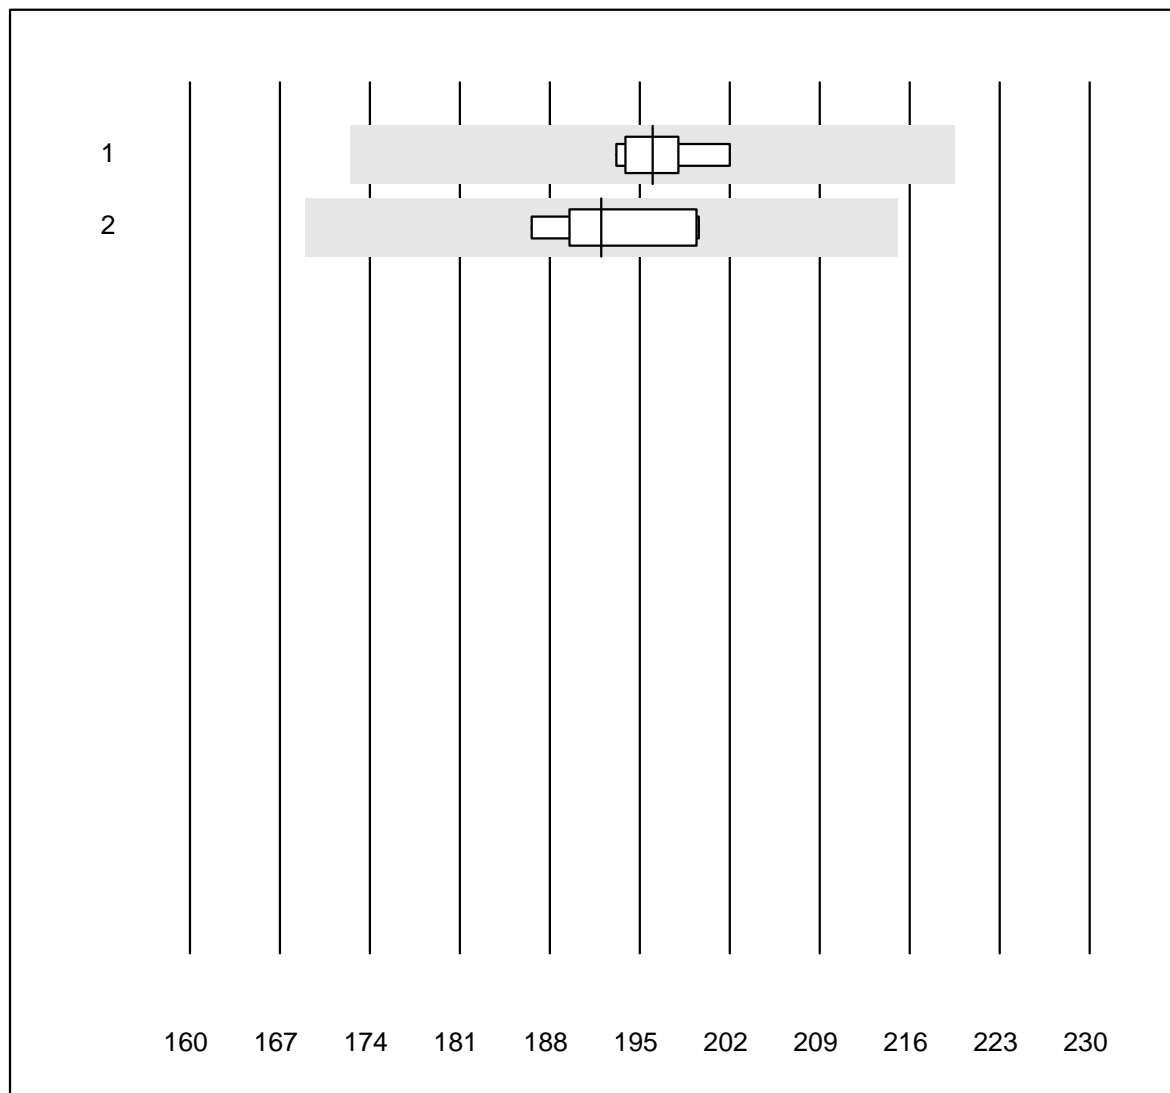


Tolérance MQ : 12 %

Chlorures-urine (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	7	100.0	0.0	0.0	196	1.6	e
2 Cobas	7	100.0	0.0	0.0	192	2.6	e

Glucose-urine

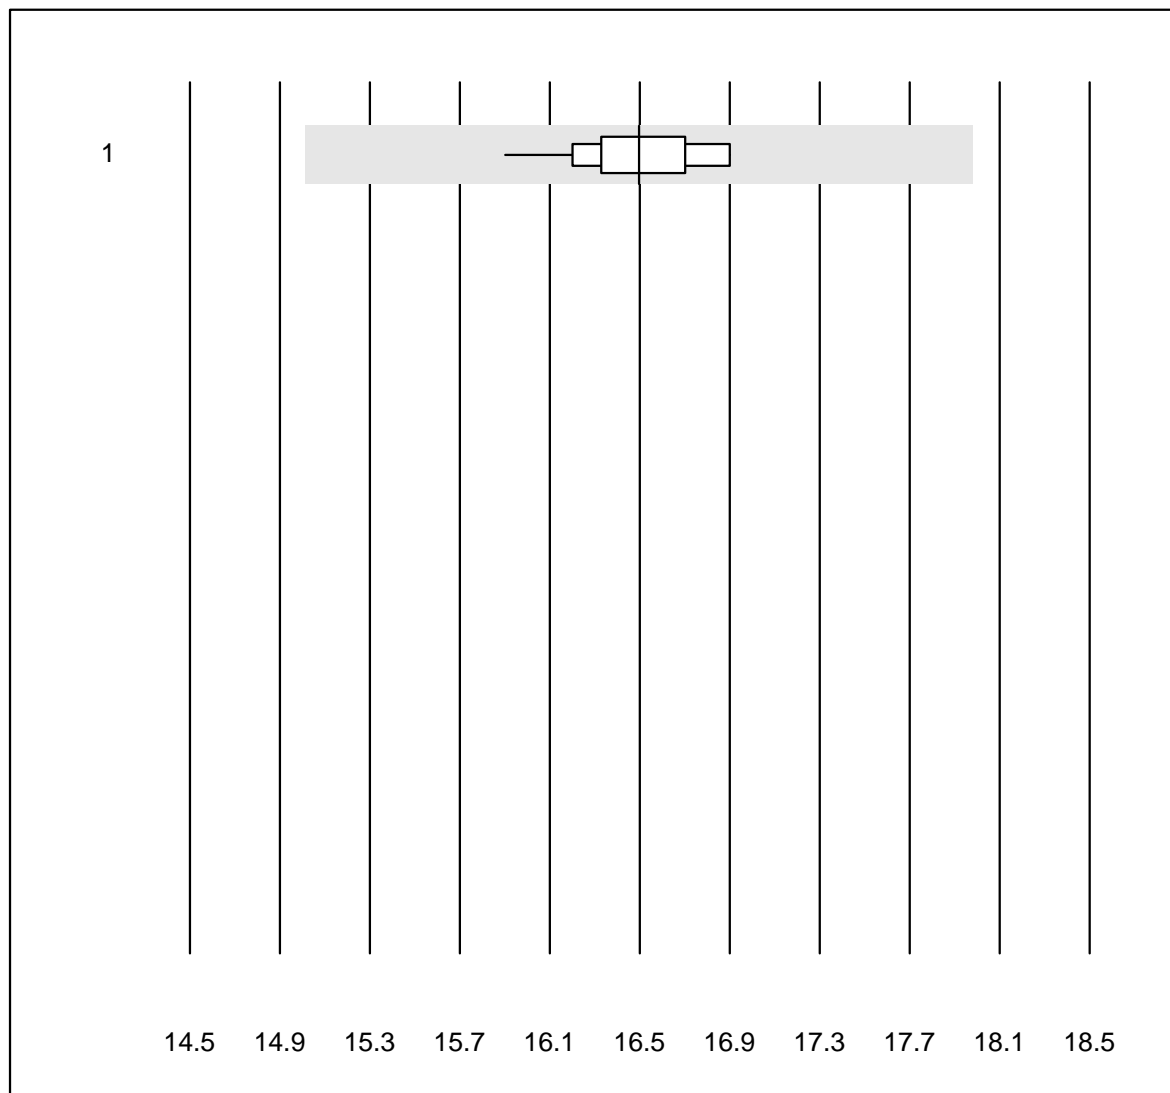


QUALAB Tolérance : 9 %

Glucose-urine (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	17	100.0	0.0	0.0	16.5	1.6	e

Magnésium-urine

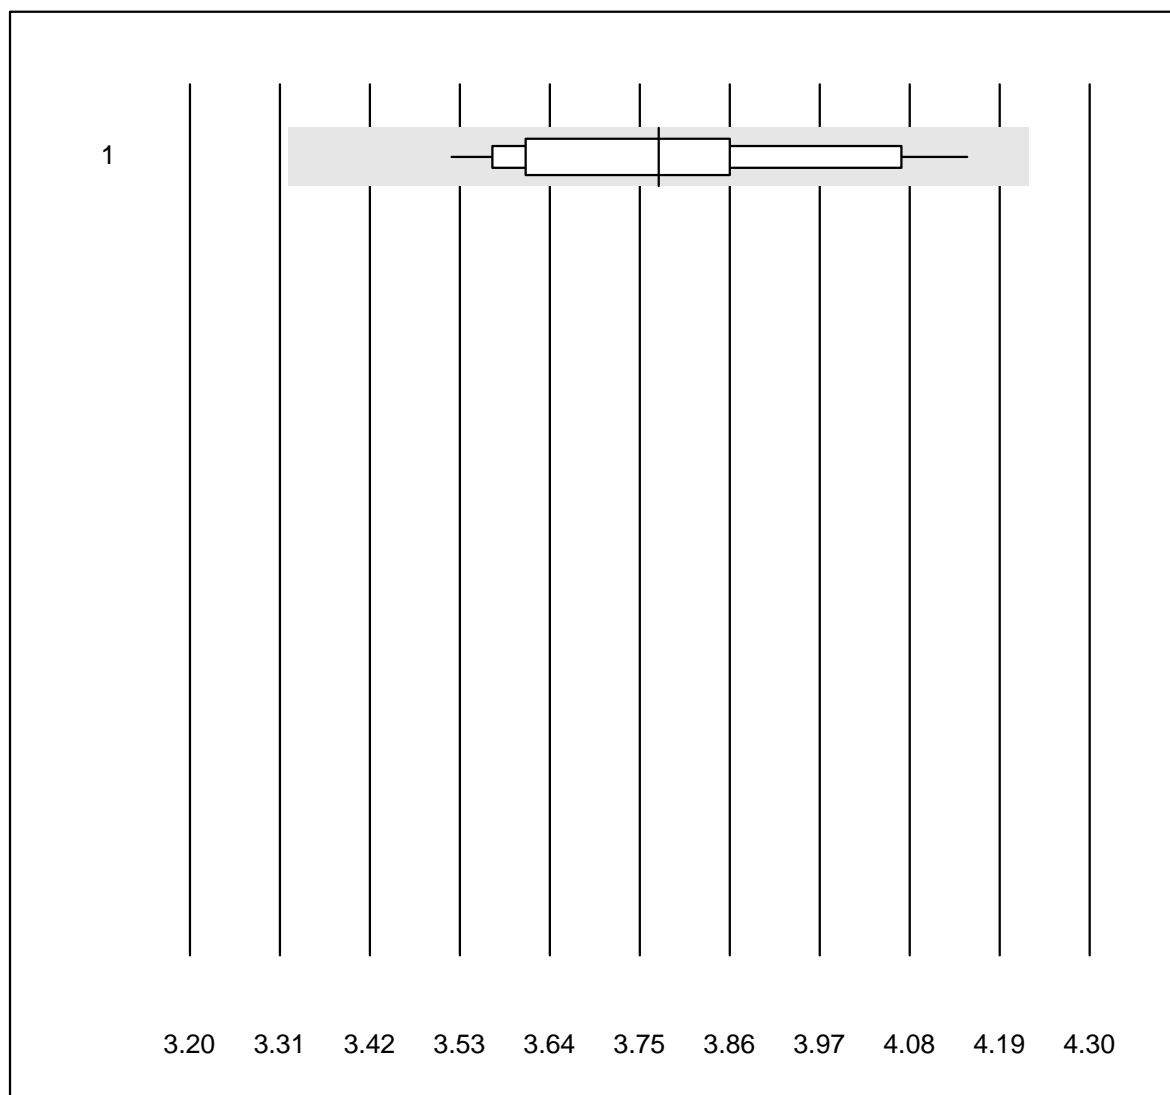


Tolérance MQ : 12 %

Magnésium-urine (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	12	100.0	0.0	0.0	3.77	5.4	e*

Osmolalité-urine

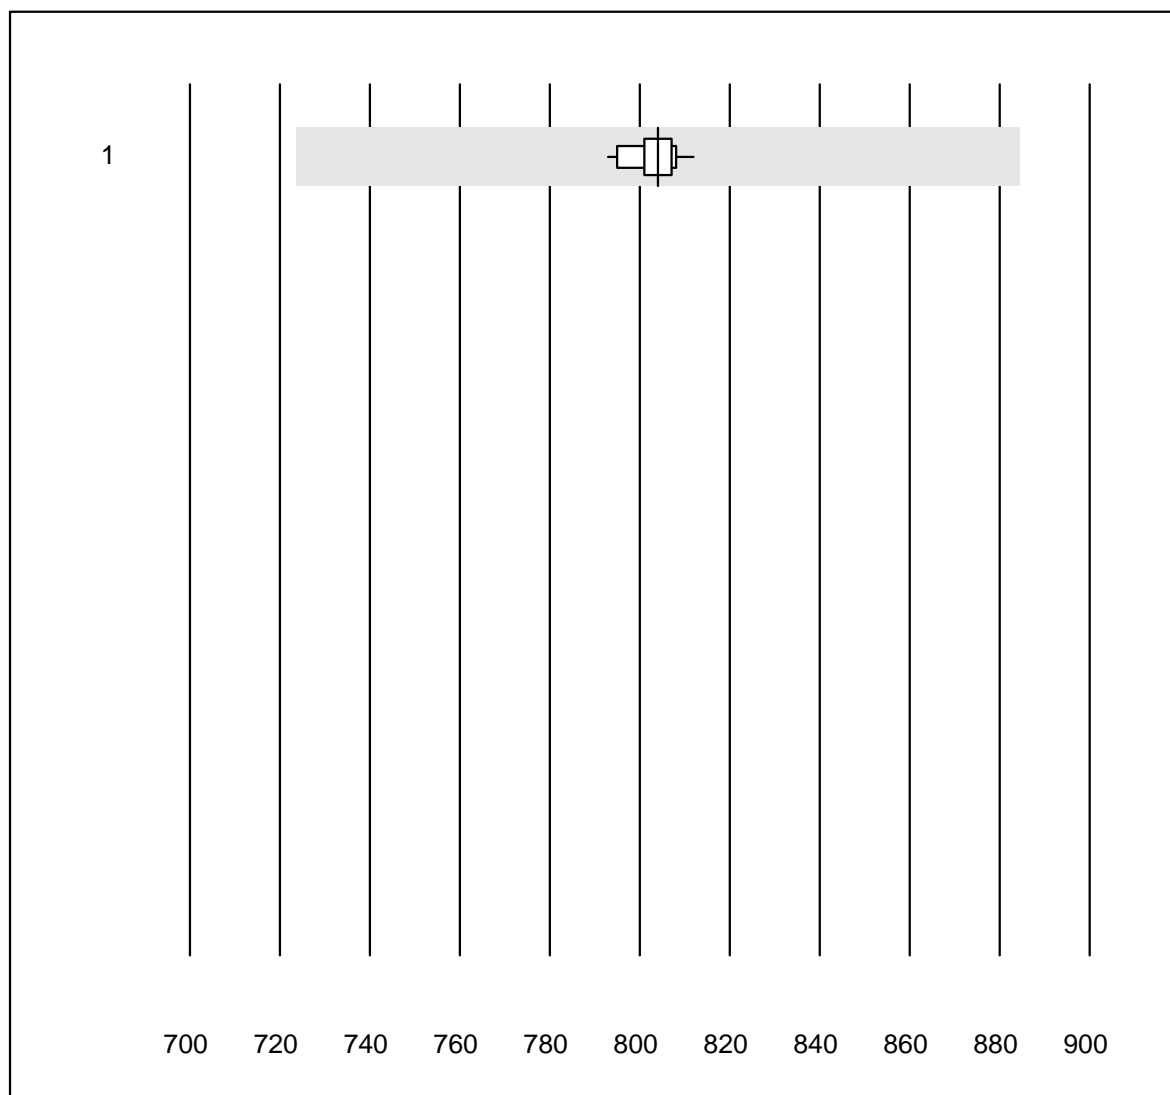


Tolérance MQ : 10 %

Osmolalité-urine (mosm/kg)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cryoscopie	16	100.0	0.0	0.0	804	0.6	e

Phosphore-urine

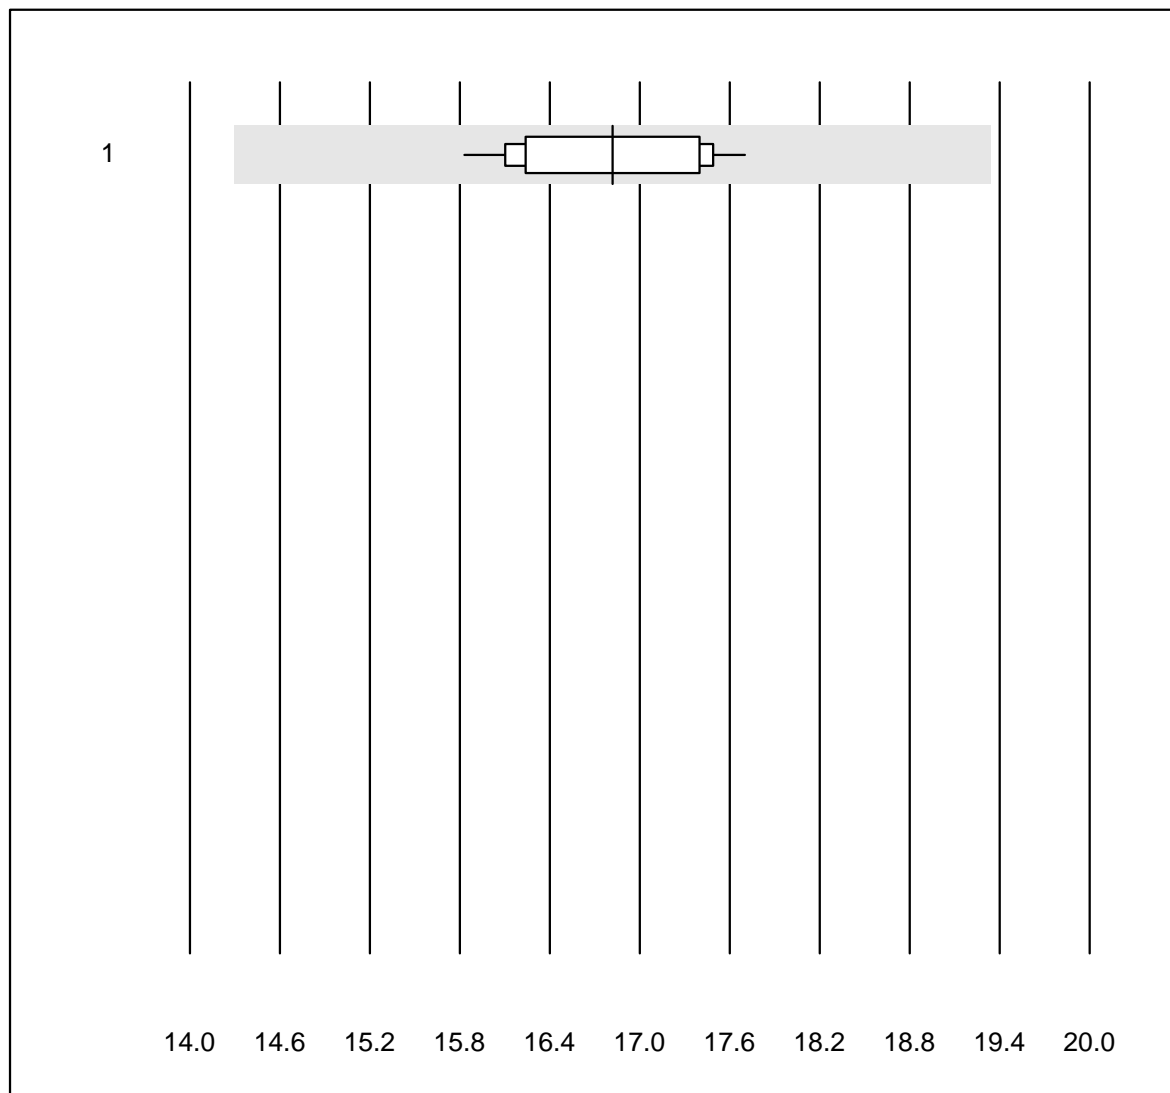


Tolérance MQ : 15 %

Phosphore-urine (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	17	100.0	0.0	0.0	16.8	3.4	e

Potassium-urine

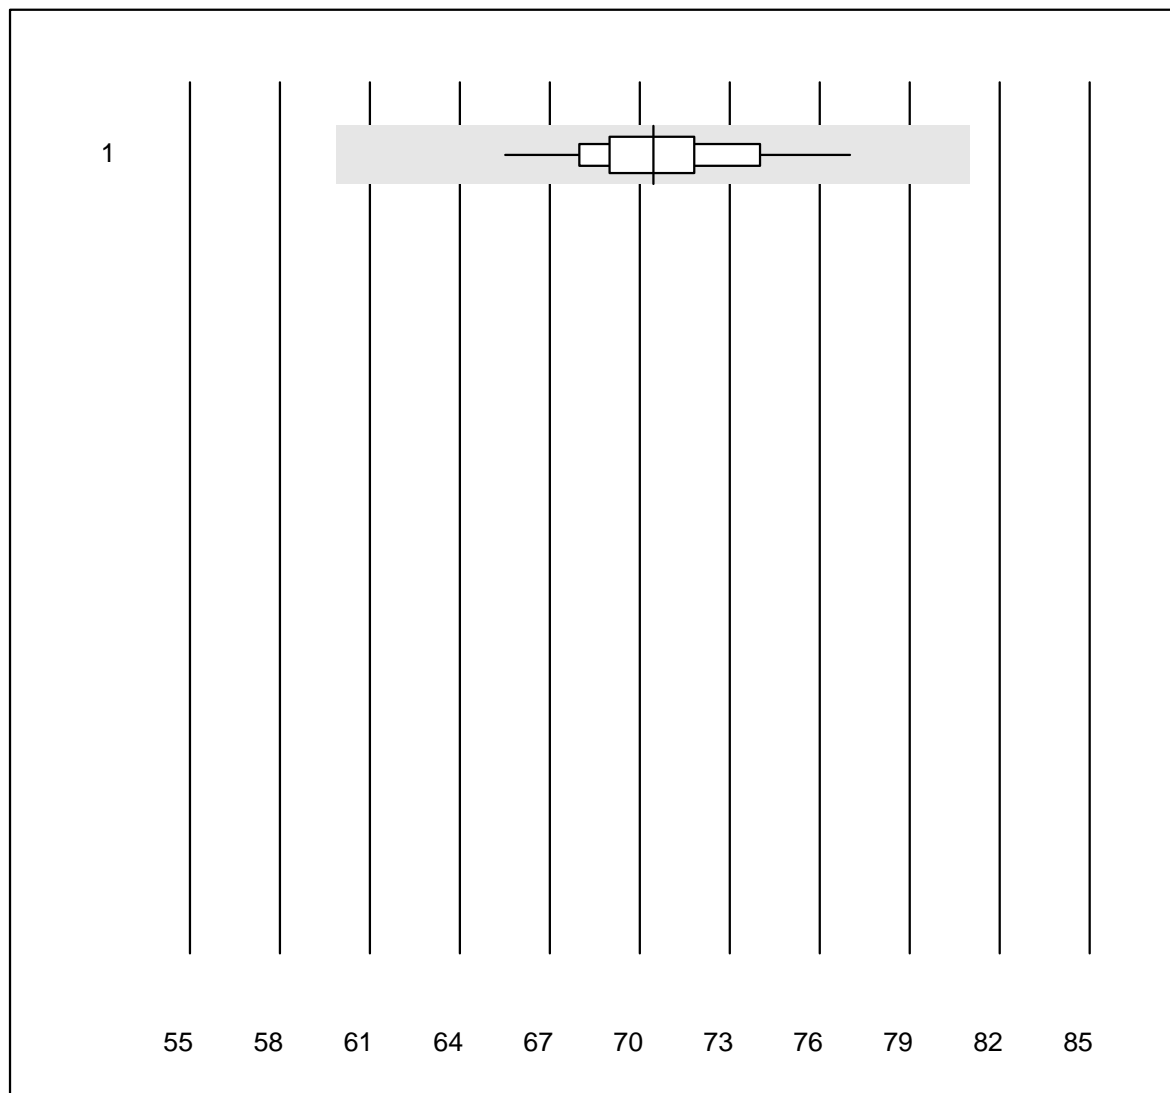


Tolérance MQ : 15 %

Potassium-urine (mmol/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	25	100.0	0.0	0.0	70	3.6	e

Protéines-urine

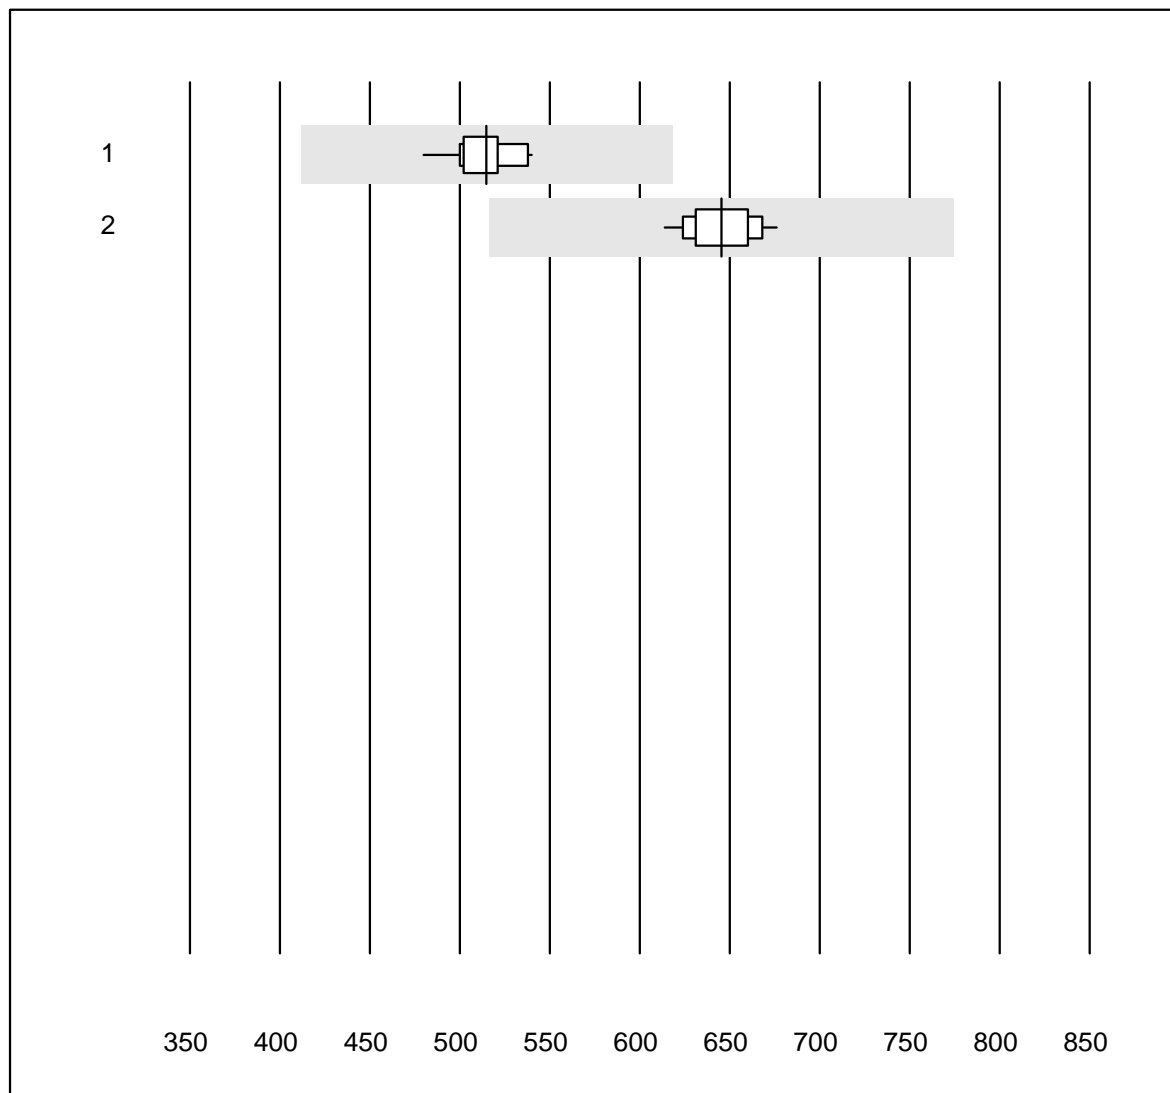


QUALAB Tolérance : 20 %

Protéines-urine (mg/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Cobas/Roche	14	100.0	0.0	0.0	514.9	3.1	e
2 Chimie humide	12	100.0	0.0	0.0	645.6	2.9	e

Sodium-urine

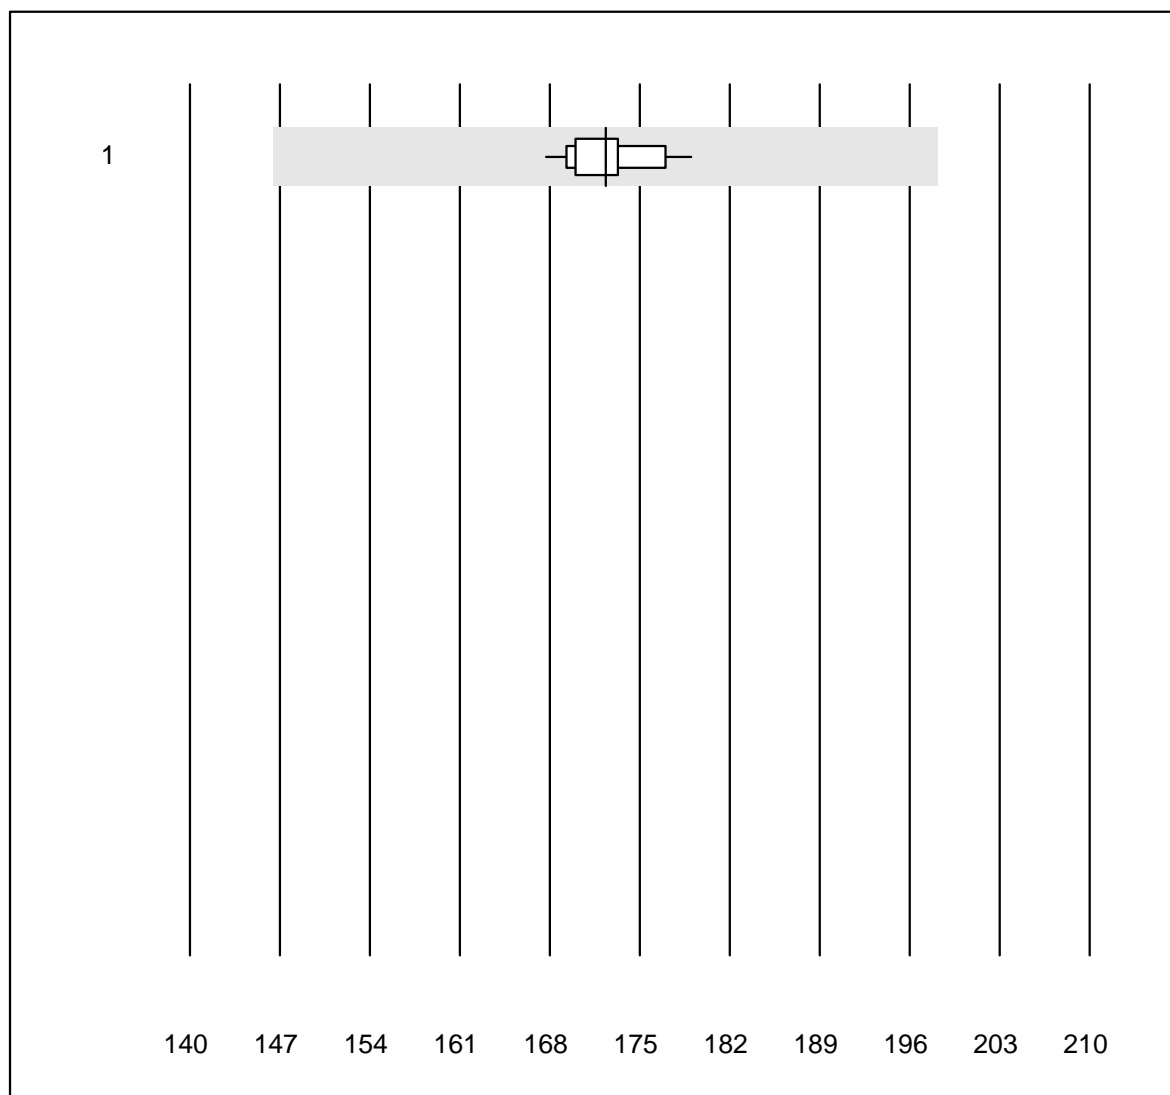


Tolérance MQ : 15 %

Sodium-urine (mmol/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	25	100.0	0.0	0.0	172	1.7	e

Urée-urine

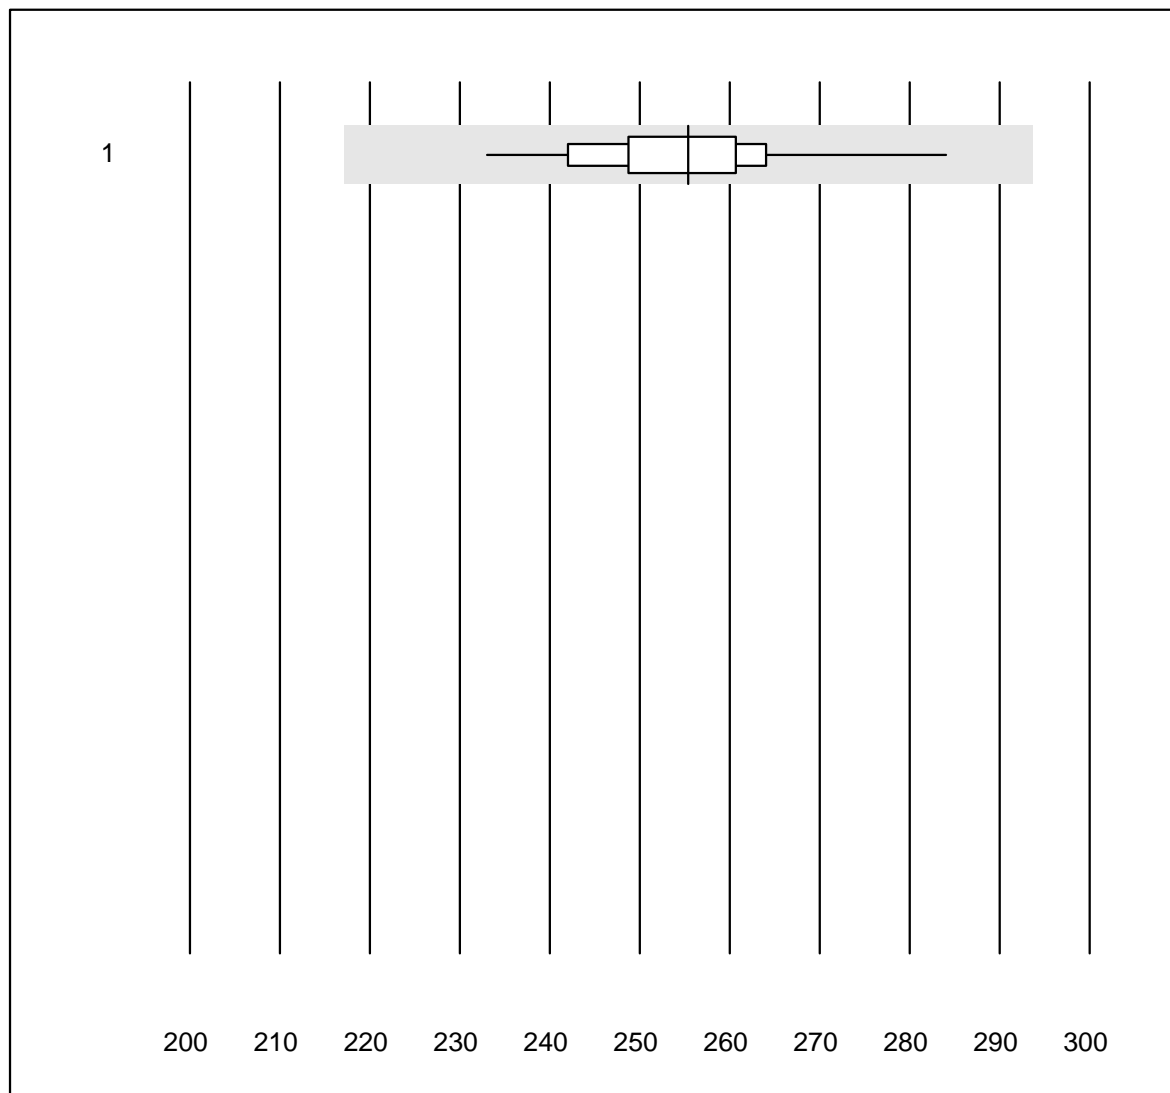


Tolérance MQ : 15 %

Urée-urine (mmol/l)

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	22	100.0	0.0	0.0	255	4.2	e

Acide urique-urine

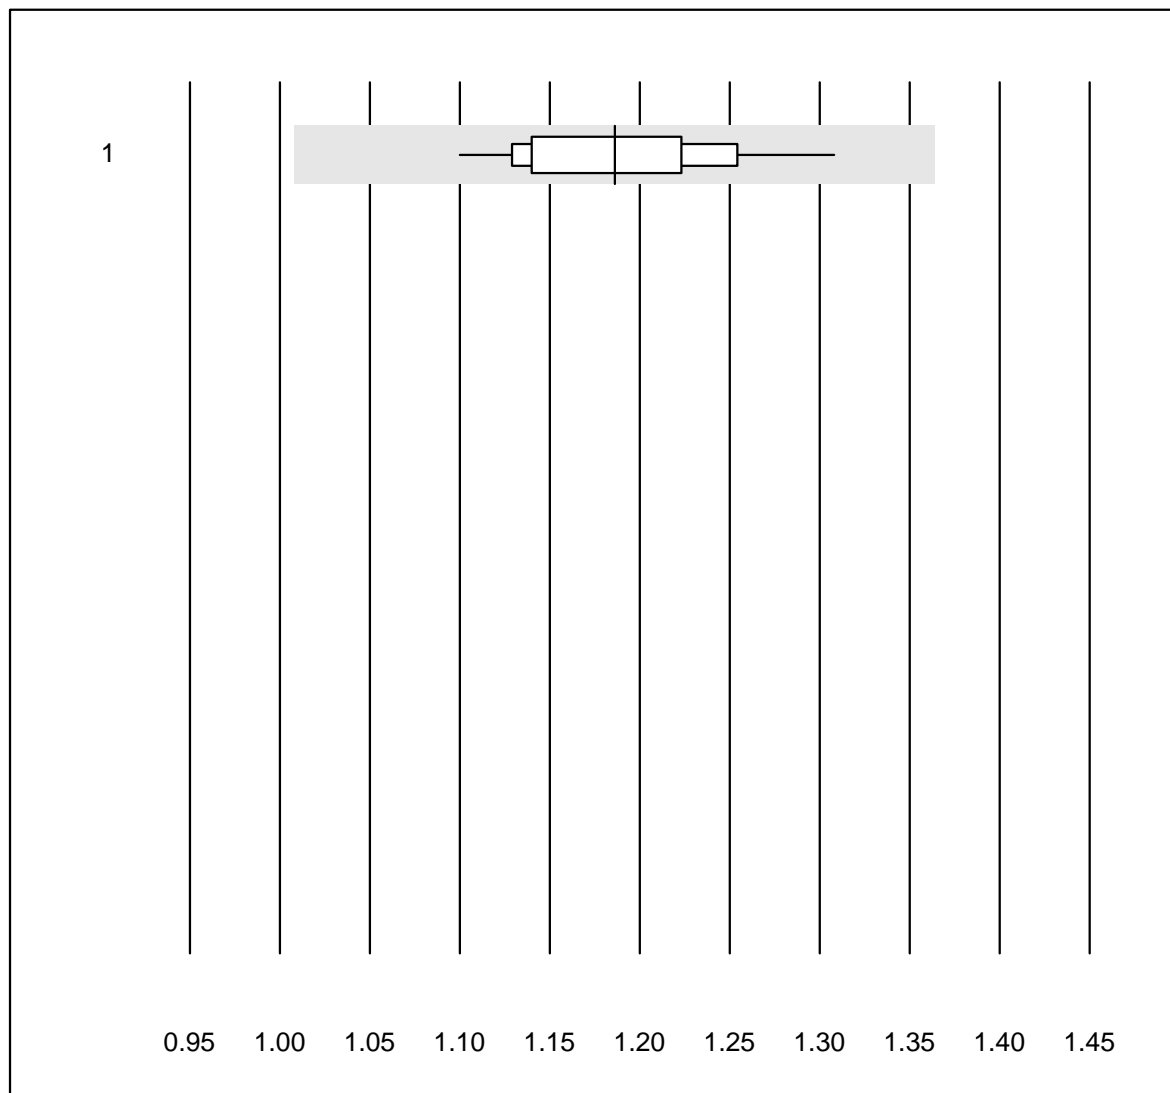


Tolérance MQ : 15 %

Acide urique-urine (mmol/l)

No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Chimie humide	16	100.0	0.0	0.0	1.19	4.7	e

Gravité spécifique-urine

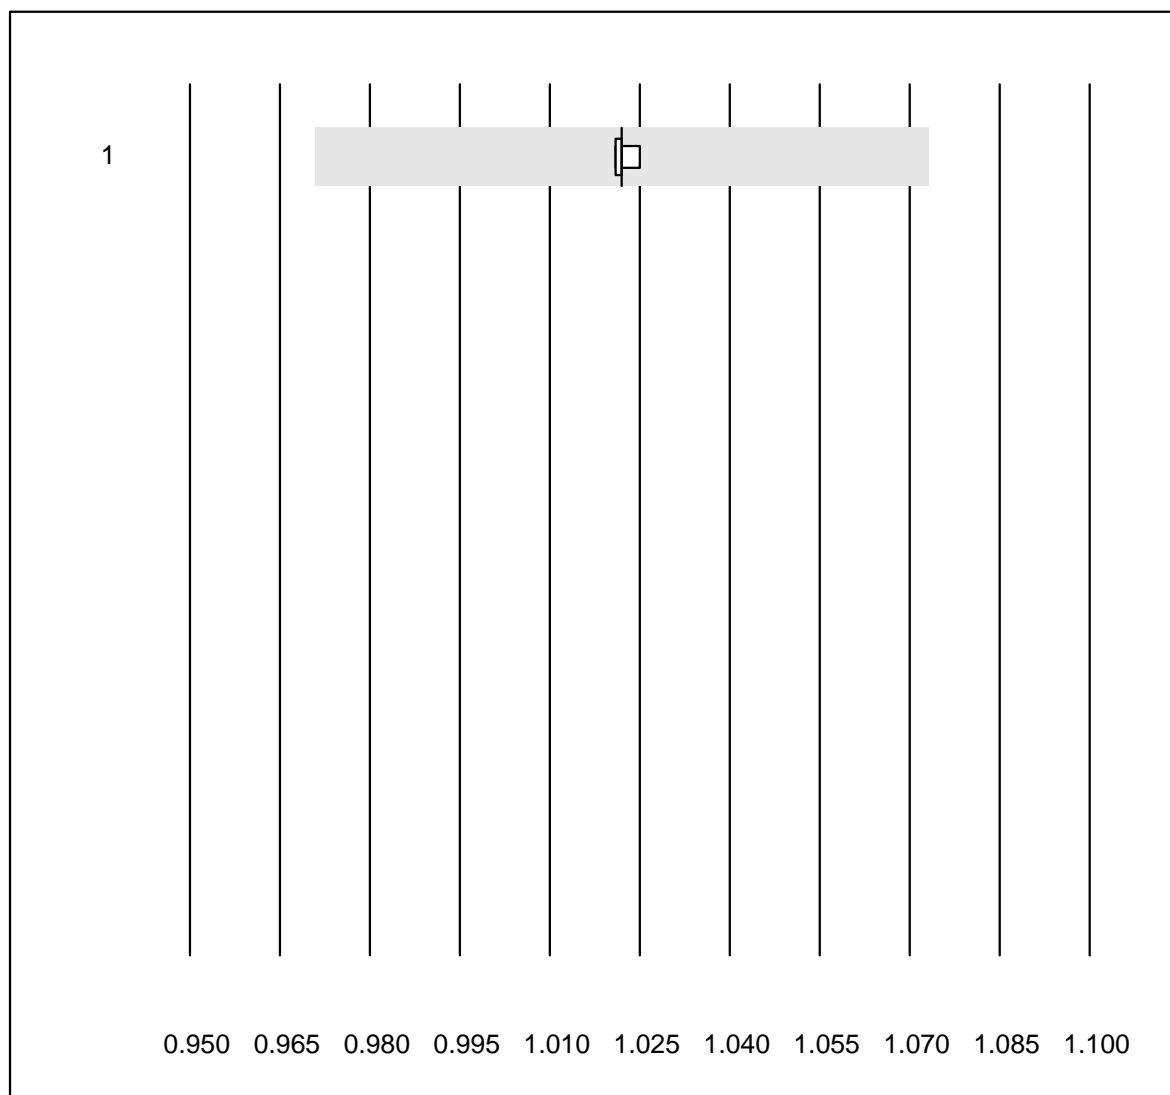


Tolérance MQ : 5 %

Gravité spécifique-urine ()


No.Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Refraktometer	4	100.0	0.0	0.0	1.022	0.2	e

Ethylglucuronid

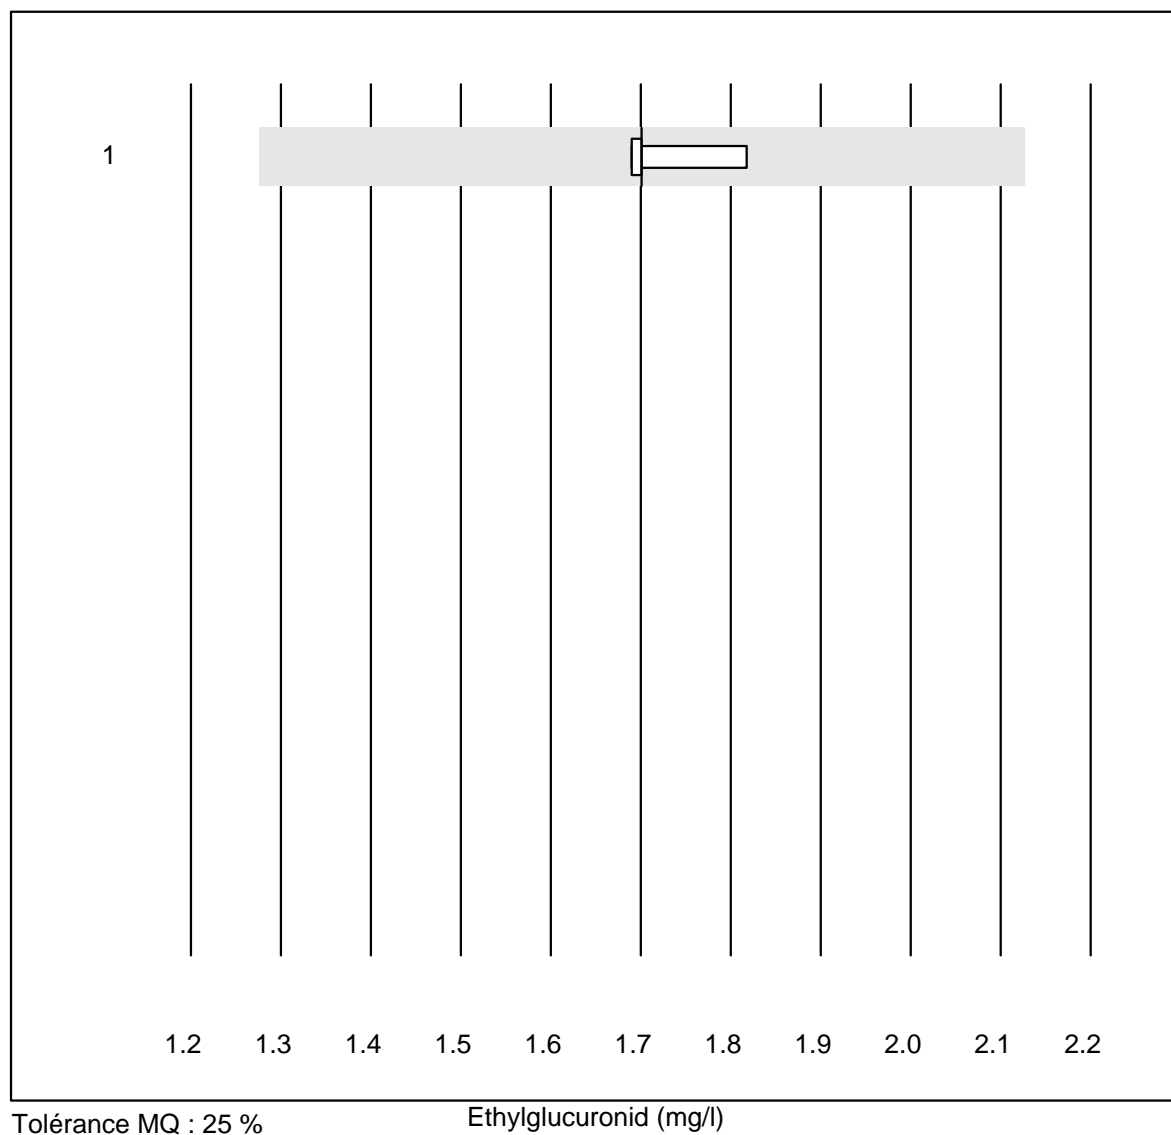


No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	1.70	3.5	e

Microalbumine

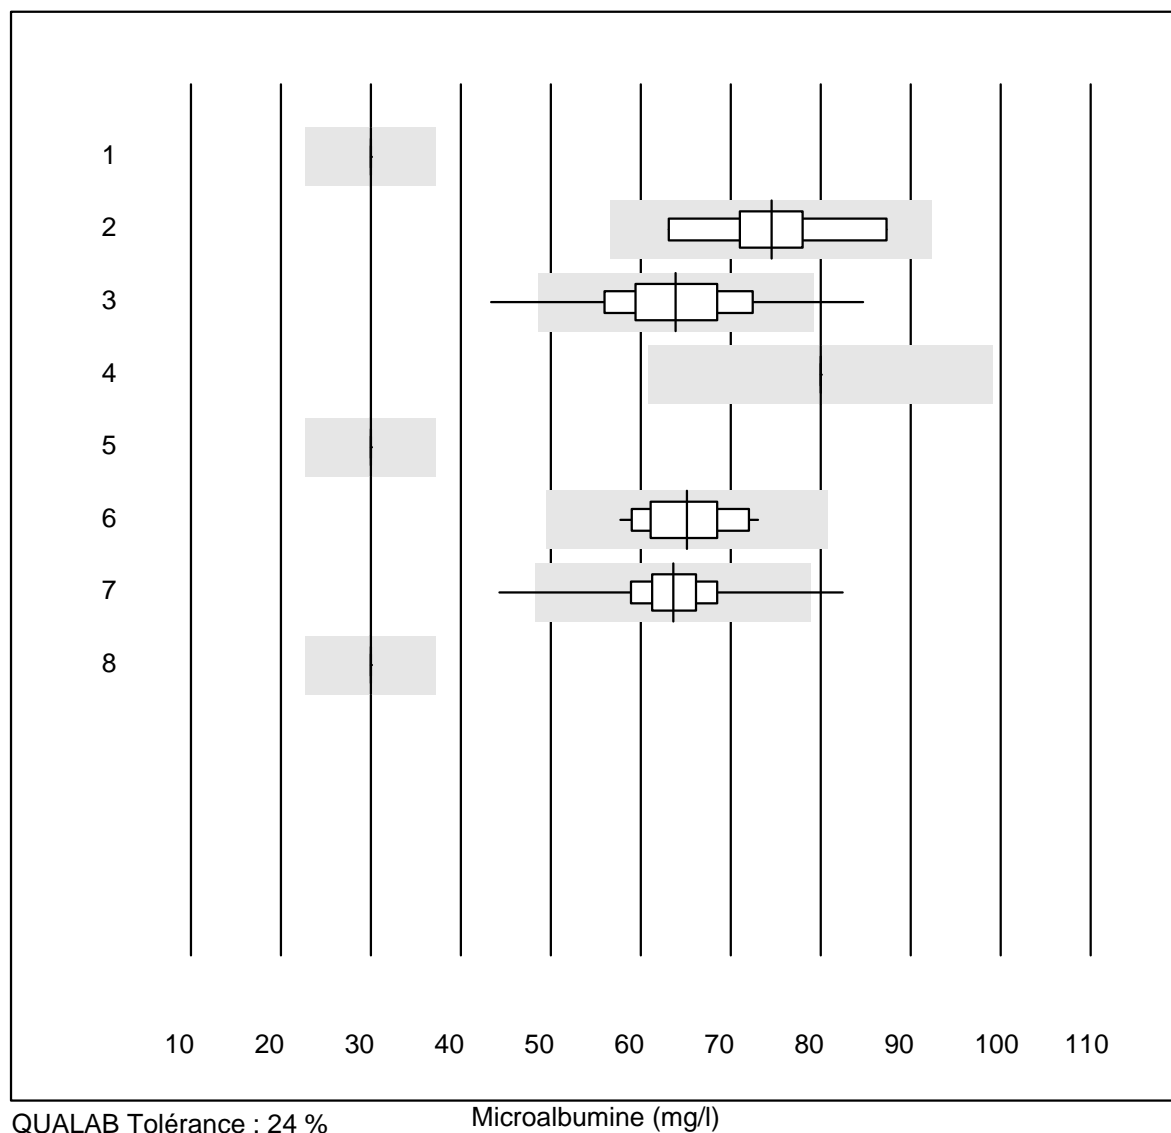

No. Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1 Aution	5	80.0	0.0	20.0	30.0	0.0	e
2 AFIAS	9	100.0	0.0	0.0	74.5	10.6	e*
3 Afinion	453	95.2	2.2	2.6	63.9	10.3	e
4 Sysmex U	19	63.2	0.0	36.8	80.0	0.0	e
5 Autres méthodes	5	80.0	0.0	20.0	30.0	0.0	e
6 Turbidimétrie	30	96.7	0.0	3.3	65.1	6.9	e
7 DCA2000/Vantage	150	93.4	1.3	5.3	63.6	6.9	e
8 Siemens Clinitek	17	58.8	0.0	41.2	30.0	0.0	e

Créatinine urine

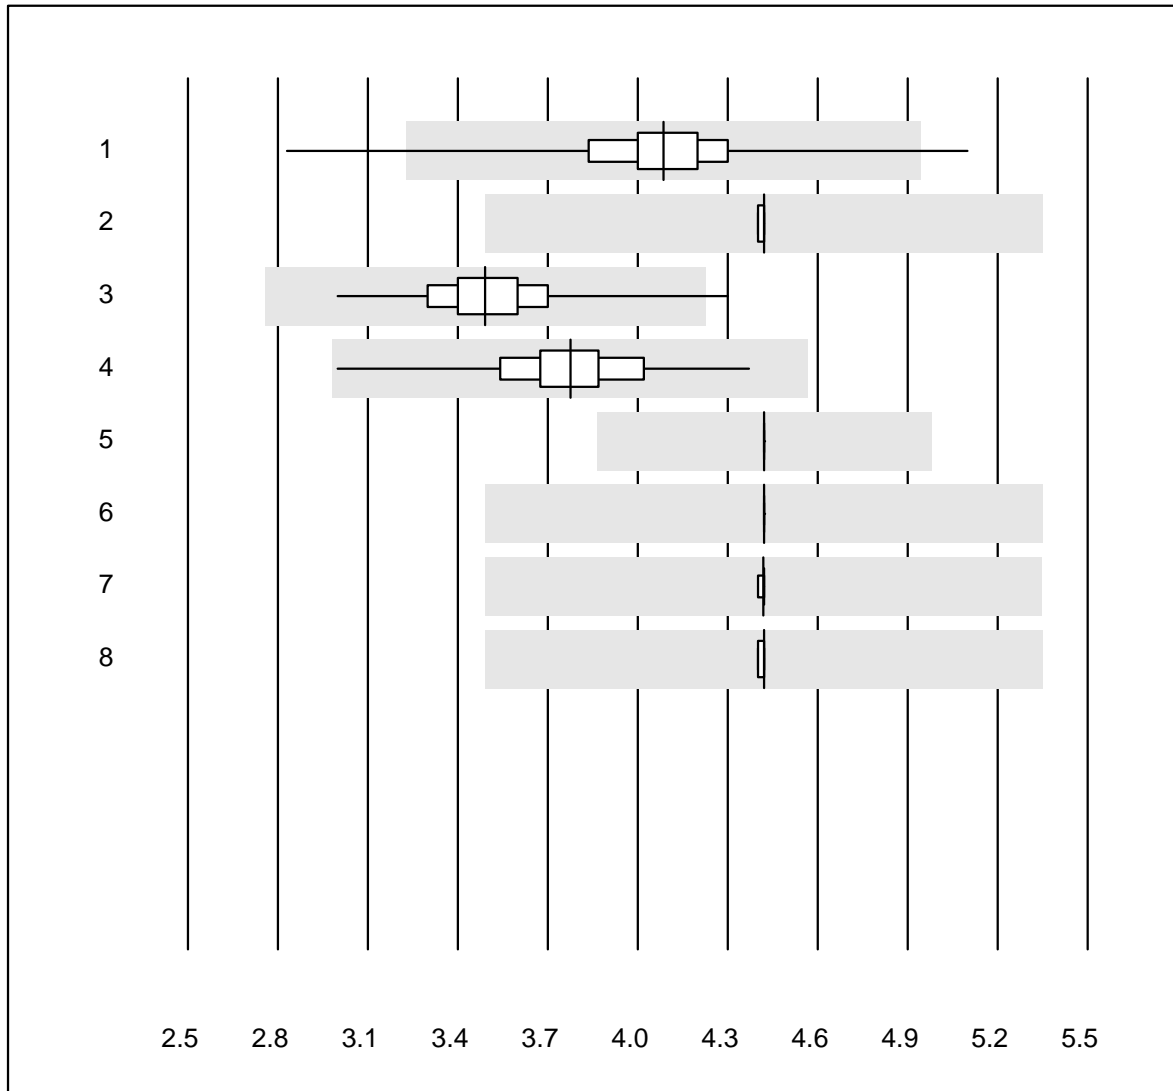

QUALAB Tolérance : 21 %

Créatinine urine (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	CV%	Type
1	DCA2000/Vantage	148	91.9	4.7	3.4	4.1	7.1	e
2	Siemens Clinitek	6	66.7	0.0	33.3	4.4	0.2	e
3	Afinion	451	96.9	0.2	2.9	3.5	5.5	e
4	Chimie humide	41	97.6	0.0	2.4	3.8	6.0	e
5	Sysmex U	15	86.7	0.0	13.3	4.4	0.0	a
6	Aution	5	60.0	0.0	40.0	4.4	0.0	e
7	Siemens Clinitek	11	72.7	0.0	27.3	4.4	0.2	e
8	Autres méthodes	5	80.0	0.0	20.0	4.4	0.2	e