Verein für medizinische Qualitätskontrolle
Association pour le contrôle de qualité médical
Associazione per il controllo di qualità medico

Commentaire de l’essai interlaboratoire

2026-3

Verein für medizinische Qualitätskontrolle, Universitätsspital Zürich, 8091 Zürich
T: 044 255 34 11, www.MQZH.ch, info@mqzh.ch

Échantillons de l'essai interlaboratoire

L'homogénéité et la stabilité ont été vérifiées pour tous les échantillons avant respectivement pendant l'envoi et aucune anomalie n'a été constatée. Les tests de conformité ont été réalisés par les laboratoires de l'Hôpital Universitaire de Zürich (http://www.uzl.usz.ch/). Ont été produits spécifiquement pour MQ en sous-traitance les échantillons d'essai interlaboratoire suivants:
B2 Uricult, H4 Hématologie parasitaire, K14 Marqueur tumoral

Détermination des valeurs-cible

Pour chaque valeur-cible est indiqué le mode de détermination utilisé selon les termes de la norme ISO17043:2010, B2.1 (Colonne "Type"):

a Valeur connue, sur la base de la production.
b Valeur de référence certifiée lors de l'utilisation d'échantillons spécifiques
c Valeur de référence déterminée par analyse
d „Consensus value" des laboratoires d'experts
e „Consensus value" des participants

Pour les groupes de méthode incluant plus de 9 participants, les valeurs cibles sont déterminées comme étant la „Consensus value" ("e") des participants. Pour la détermination de ces valeurs cibles est utilisée la moyenne réalisée par le groupe de méthodes. Les résultats qui présentent un écart par rapport à la valeur cible supérieur à 1.5 fois la tolérance Qualab, sont considérés comme résultats aberrants et exclus du calcul de la valeur de référence. Les résultats des essais d'aptitude sont utilisés comme valeur de base pour éliminer les taux aberrants. Afin de mettre à disposition de tous les participants des valeurs-cible les plus pertinentes possibles, d'autres procédures peuvent également être utilisées pour des groupes de méthode plus restreints.

Unsicherheit der ermittelten Zielwerte

L'incertitude-type (ux) est calculée à l'aide de la formule suivante (ISO13528):
ux= (Valeur-cible/100) * (1.25/Racine carrée du "nombre des participants") * CV en %

- ux est exprimée dans la même unité que la valeur-cible
- ux peut être comparée avec l'écart-type du collectif des participants (Ecart-type=Valeur-cible * CV en % / 100)
- Pour un nombre de participants >18, l'incertitude-type (ux) est significativement plus petite que la dispersion du collectif des participants et peut donc être négligée.


Tolérances QUALAB et MQ

Pour les analyses obligatoires sont utilisées les tolérances fixées par Qualab (www.qualab.ch, contrôle de qualité externe). Pour les analyses non-obligatoires, les tolérances sont fixées par le directeur de MQ pilotant l'essai interlaboratoire.

Si l'incertitude déterminée de la valeur de référence ux est supérieure à 15% de la tolérance QUALAB ou de MQ, la lettre qui caractérise le type de détermination de la valeur-cible est en outre marquée d'une étoile (par exemple "e*"). Nous rendons ainsi les participants attentifs au fait que l'incertitude de la valeur de référence peut avoir une influence sur l'évaluation.

Représentation graphique

La représentation graphique des résultats est la suivante:

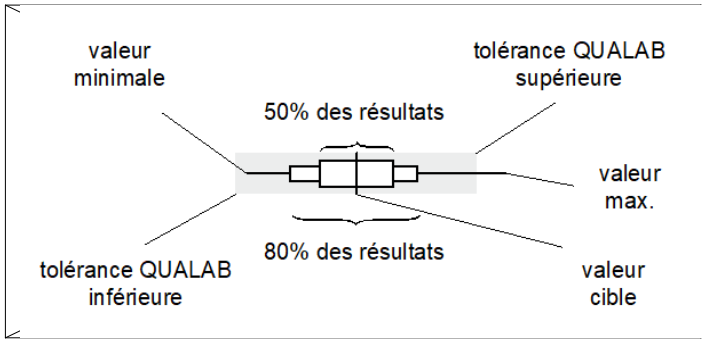

Comparaison des appareils

Les données de ce rapport vous permettent de comparer les performances respectives des divers appareils. Toutefois, vous devez tenir compte des points suivants:


- Le contrôle Chimie K1 est un sérum de contrôle commercialisé prêt à l'emploi. Même si l'échantillon est d'origine humaine, des effets matriciels sont possibles. Ceux-ci dépendent de l'appareil et peuvent générer des valeurs cible différentes.
- Seul un échantillon a été mesuré. La dispersion des résultats étant dépendante de la nature de l'échantillon (effets matriciels) et du niveau du résultat, les coefficients de variation déterminés (CV en %) ne sont pas toujours valables.
- Une grande partie des taux aberrants est due à des erreurs administratives (erreur d'unité, confusion des résultats) ou à des erreurs de manipulation (erreur d'échantillon, dissolution incorrecte, mélange insuffisant) et n'a rien à voir avec le type d'appareil.

Zurich, 28.09.2026

Dr. R.Fried
Directeur de l'essai interlaboratoire

Il n'est pas autorisé de publier une partie ou l'intégralité de ce rapport sans notre accord écrit préalable. L'original est conservé dans les archives sous www.mqzh.ch.

INR AVK

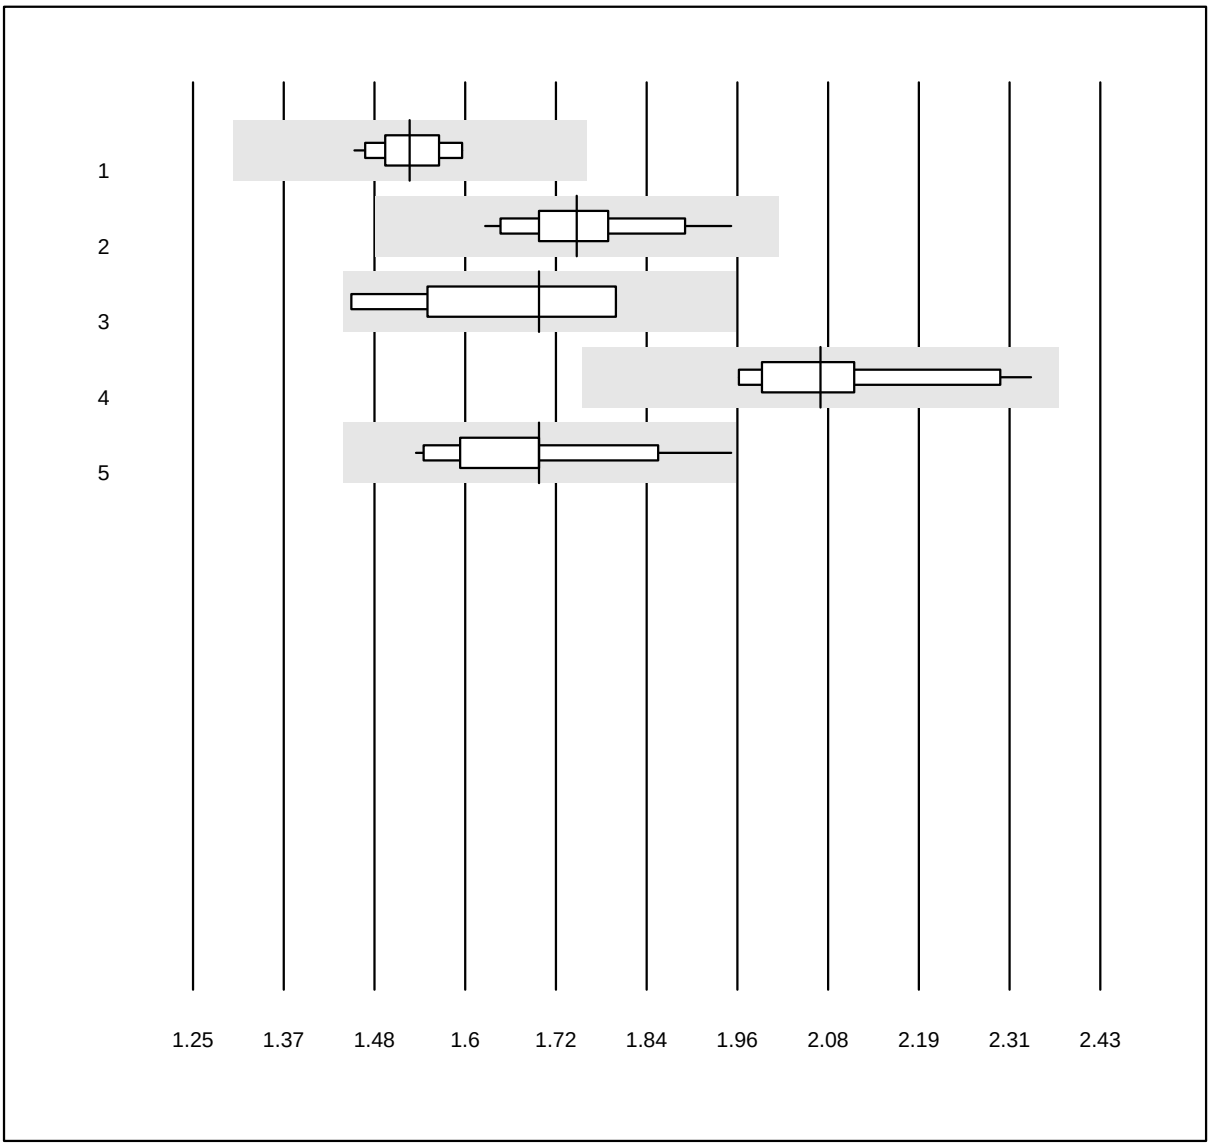


QUALAB Toleranz: 15%

INR AVK (INR)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Innovin	23	100.0	0.0	0.0	1.53	3.0	e
2	Neoplastin R	13	100.0	0.0	0.0	1.75	4.4	e
3	Neoplastin CL Plus	5	100.0	0.0	0.0	1.70	7.7	e*
4	NeoPTimal	17	100.0	0.0	0.0	2.07	5.4	e
5	Recombiplastin 2G	14	100.0	0.0	0.0	1.70	6.0	a

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

aPTT OA

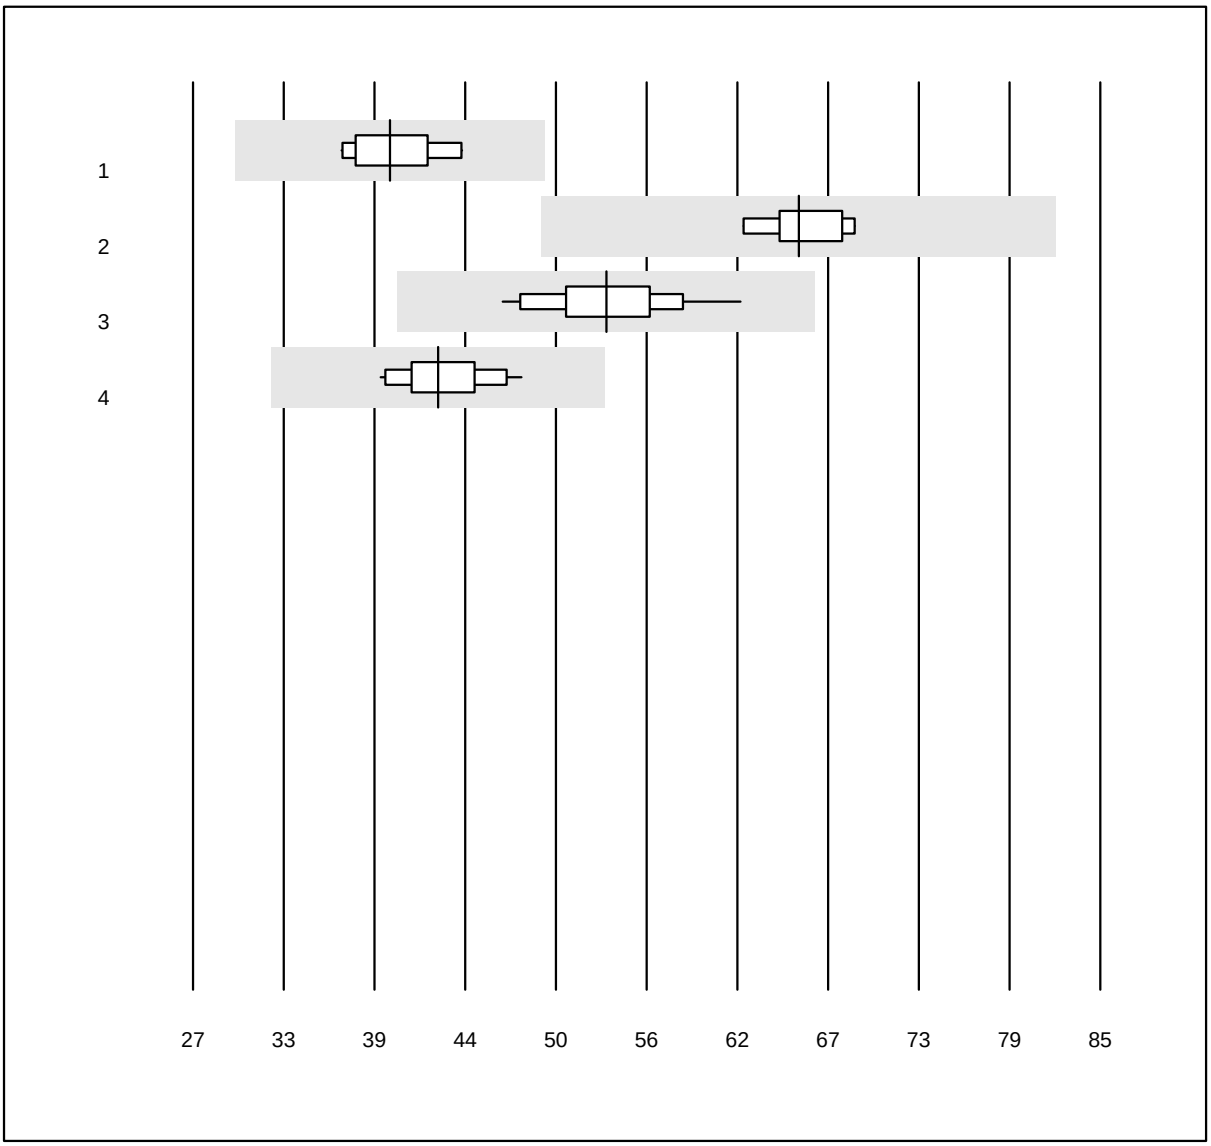


QUALAB Toleranz: 25%

aPTT OA (Sek)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Actin FS	11	100.0	0.0	0.0	39.6	7.1	e
2	Pathromtin SL	9	100.0	0.0	0.0	65.7	3.6	e
3	Stago/STA	25	100.0	0.0	0.0	53.4	6.9	e
4	aPTT-SP	14	100.0	0.0	0.0	42.7	6.0	e

Fibrinogène OA

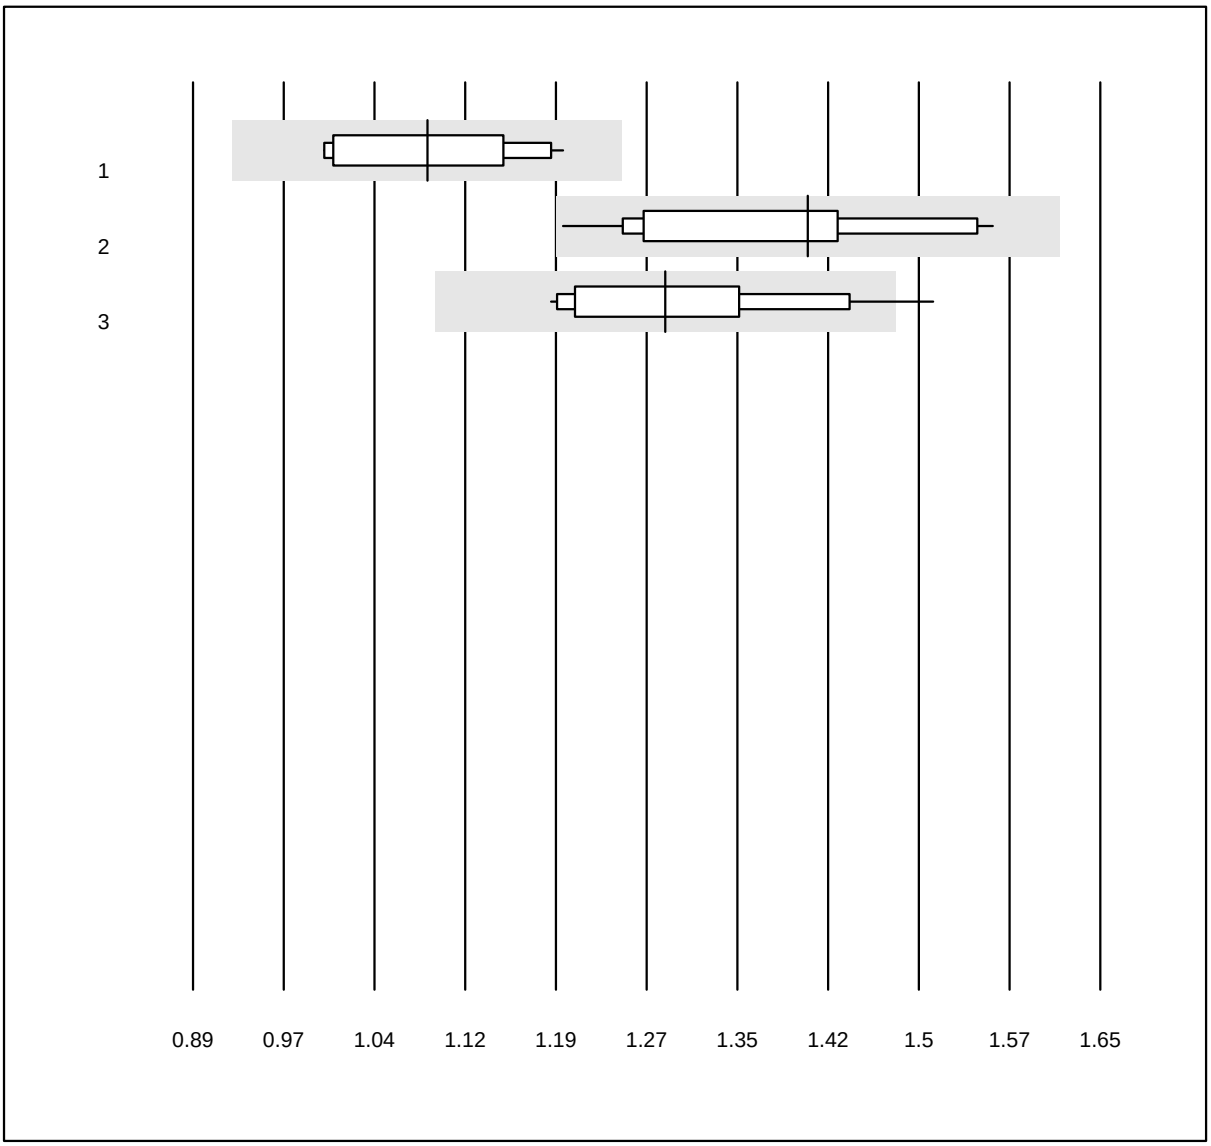


QUALAB Toleranz: 15%

Fibrinogène OA (g/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Siemens Thrombin	14	100.0	0.0	0.0	1.09	6.3	e
2	Stago/STA	21	95.2	0.0	4.8	1.41	7.7	a
3	HemosIL	14	92.9	7.1	0.0	1.29	6.9	e*

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

INR CoaguChek

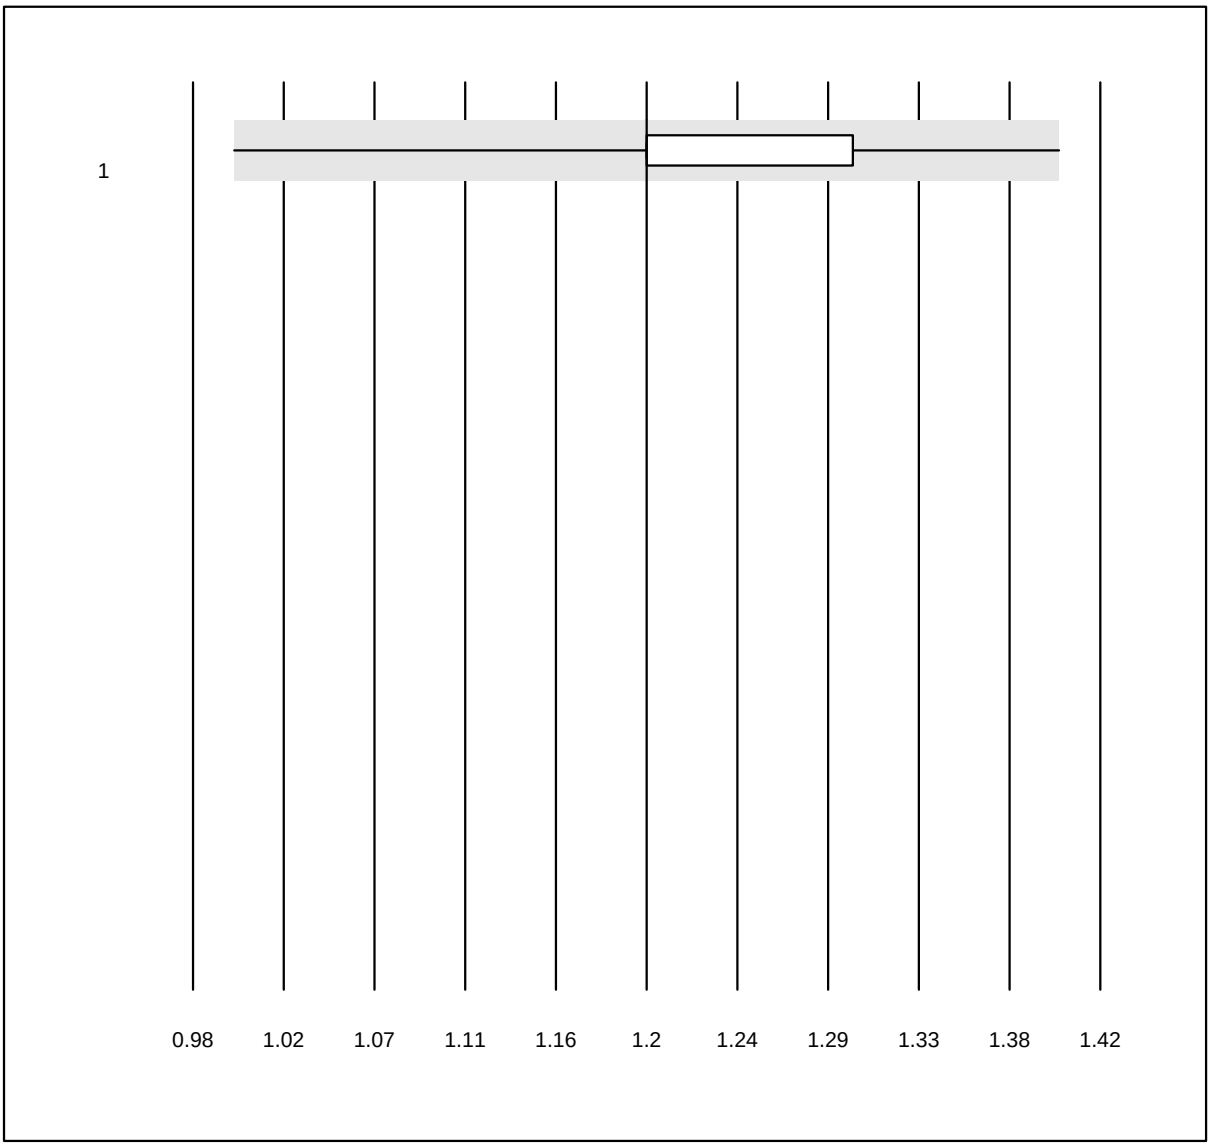


QUALAB Toleranz: 15%
(< 1.3: +/- 0.2 INR)

INR CoaguChek (INR)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	CoaguChek Pro II	1063	99.2	0.0	0.8	1.2	4.1	e

Quick N

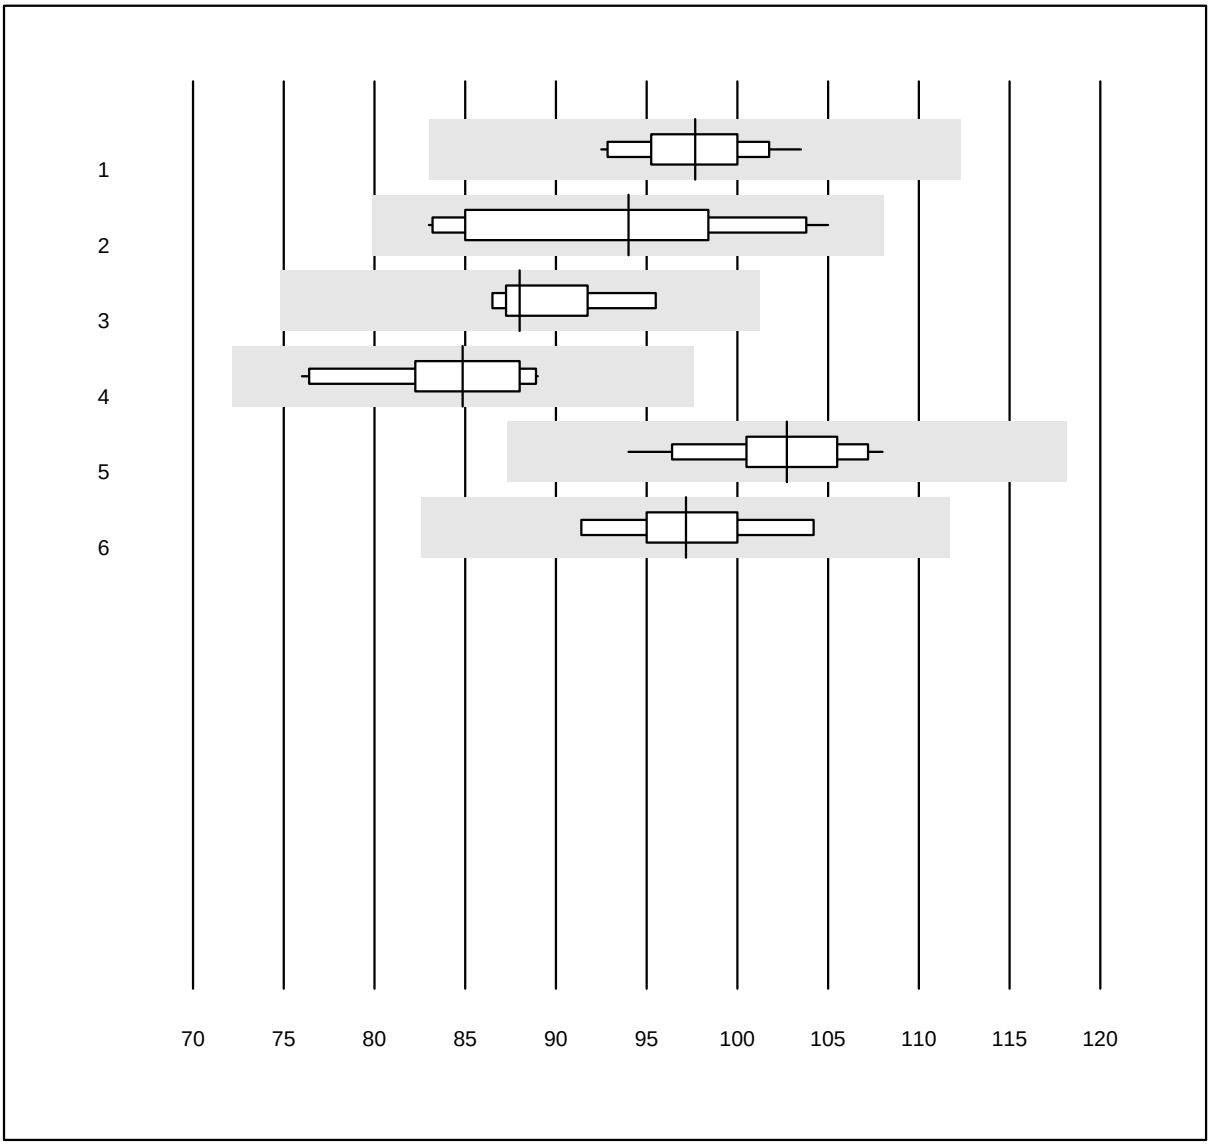


QUALAB Toleranz: 15%

Quick N (%)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Innovin	16	100.0	0.0	0.0	97.7	3.2	e
2	Neoplastin R	11	100.0	0.0	0.0	94.0	8.2	a*
3	Neoplastin CL Plus	4	100.0	0.0	0.0	88.0	3.0	e
4	NeoPTimal	10	100.0	0.0	0.0	84.9	5.0	e
5	Recombiplastin 2G	13	100.0	0.0	0.0	102.7	3.6	e
6	Autres méthodes	7	100.0	0.0	0.0	97.2	3.9	e

INR N

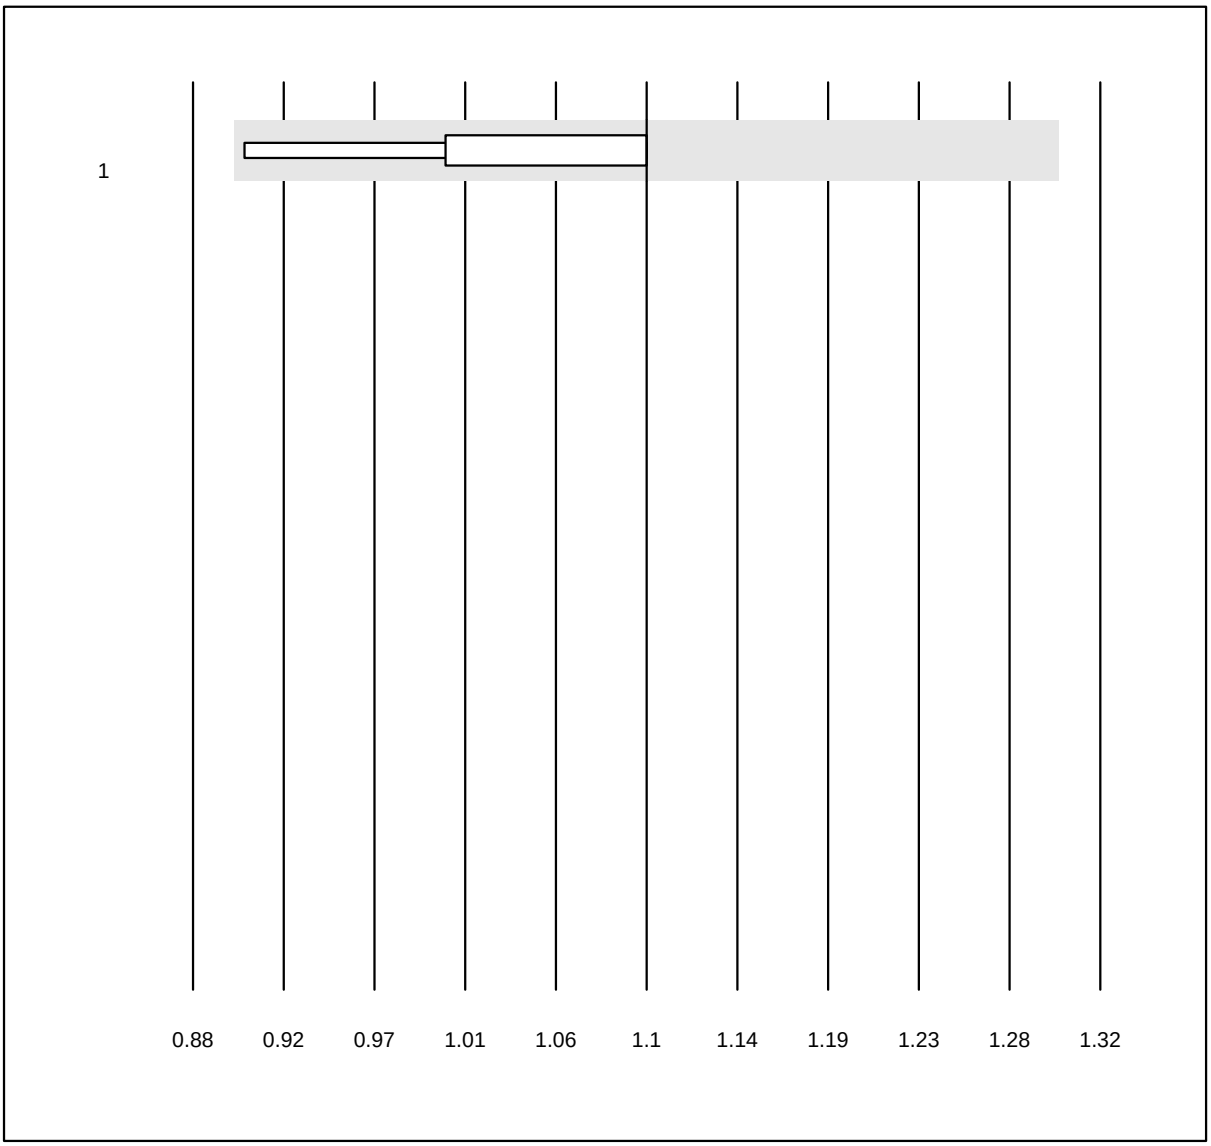


QUALAB Toleranz: 15%
(< 1.3: +/- 0.2 INR)

INR N (INR)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Neoplastin R	4	100.0	0.0	0.0	1.10	6.1	e*

3 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

aPTT N

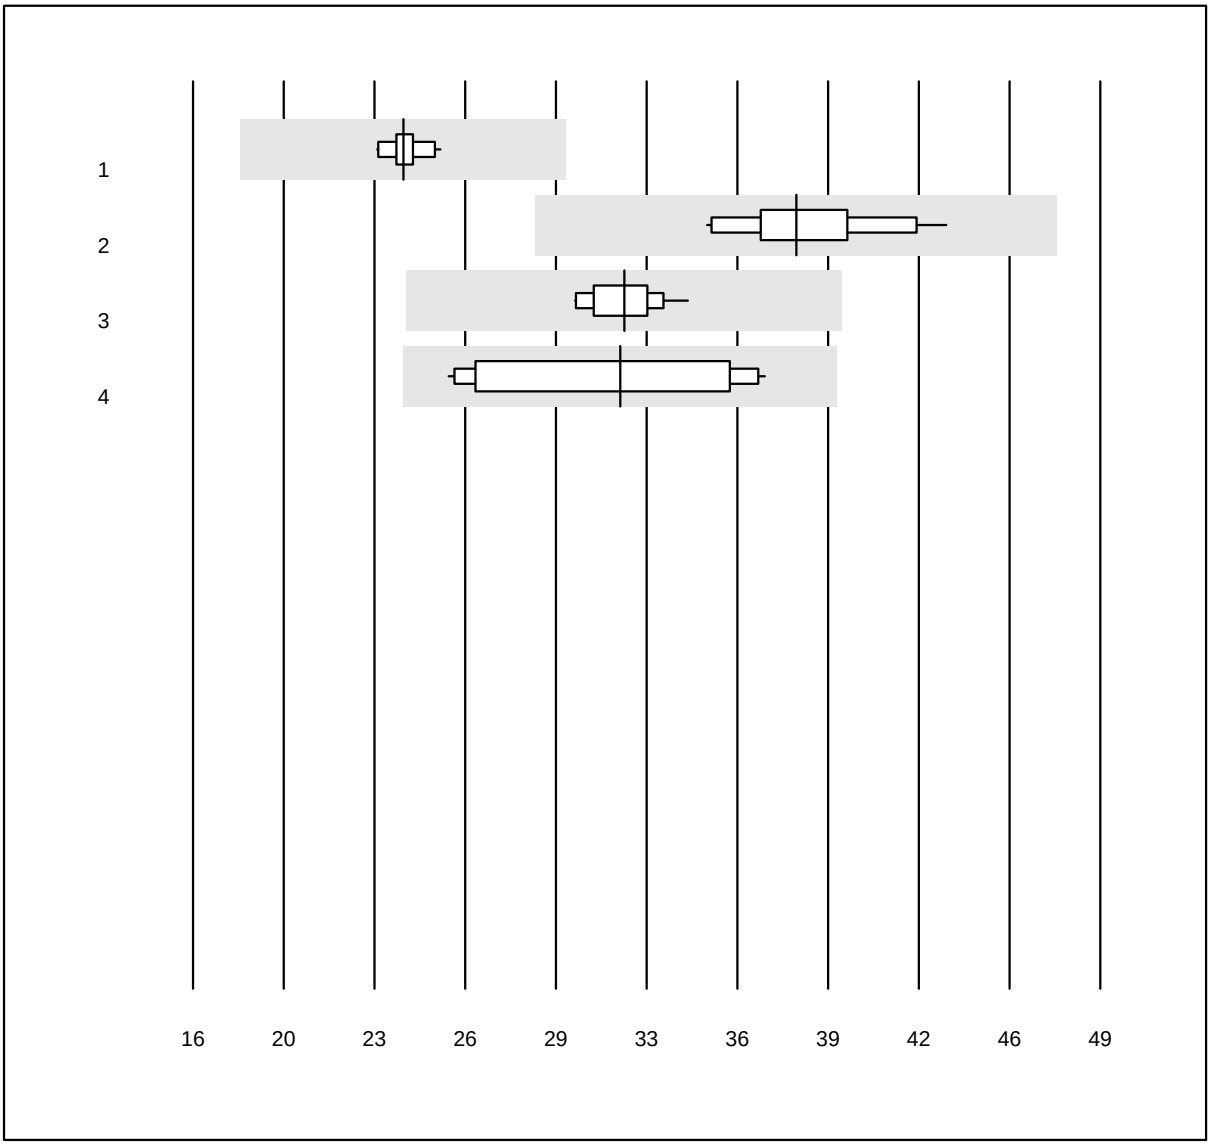


QUALAB Toleranz: 25%

aPTT N (Sek)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Actin FS	11	100.0	0.0	0.0	23.7	2.6	e
2	Pathromtin SL	13	100.0	0.0	0.0	37.9	6.3	e
3	Stago/STA	22	100.0	0.0	0.0	31.7	3.8	e
4	aPTT-SP	12	100.0	0.0	0.0	31.5	14.7	e*

Fibrinogène N

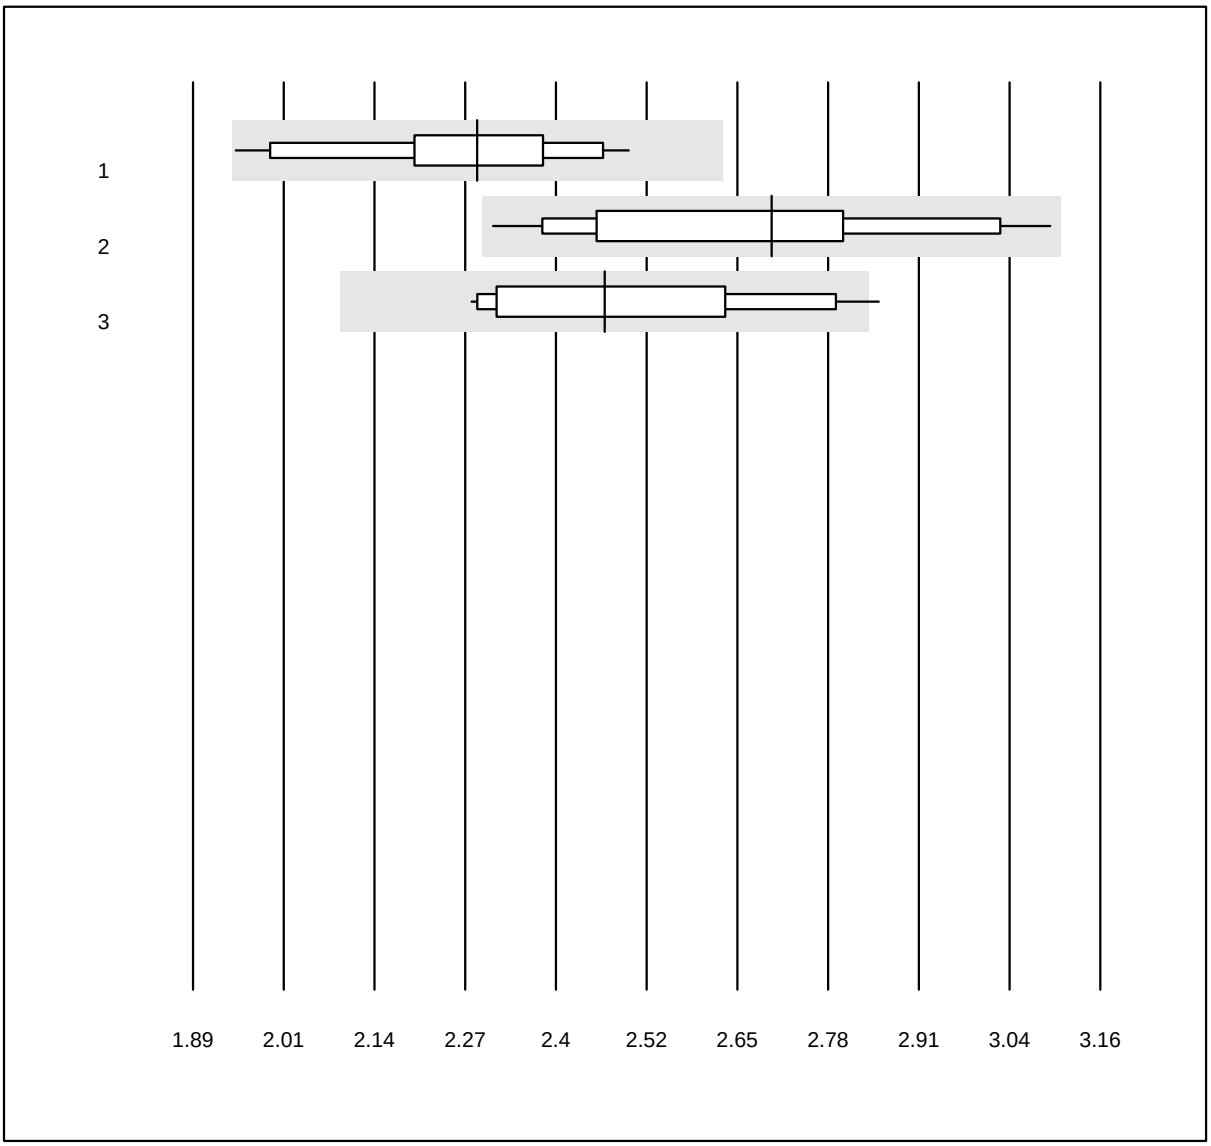


QUALAB Toleranz: 15%

Fibrinogène N (g/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Siemens Thrombin	15	100.0	0.0	0.0	2.29	6.5	e
2	Stago/STA	22	100.0	0.0	0.0	2.70	8.1	a
3	ACL	13	92.3	7.7	0.0	2.47	7.3	e*

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Faktor V

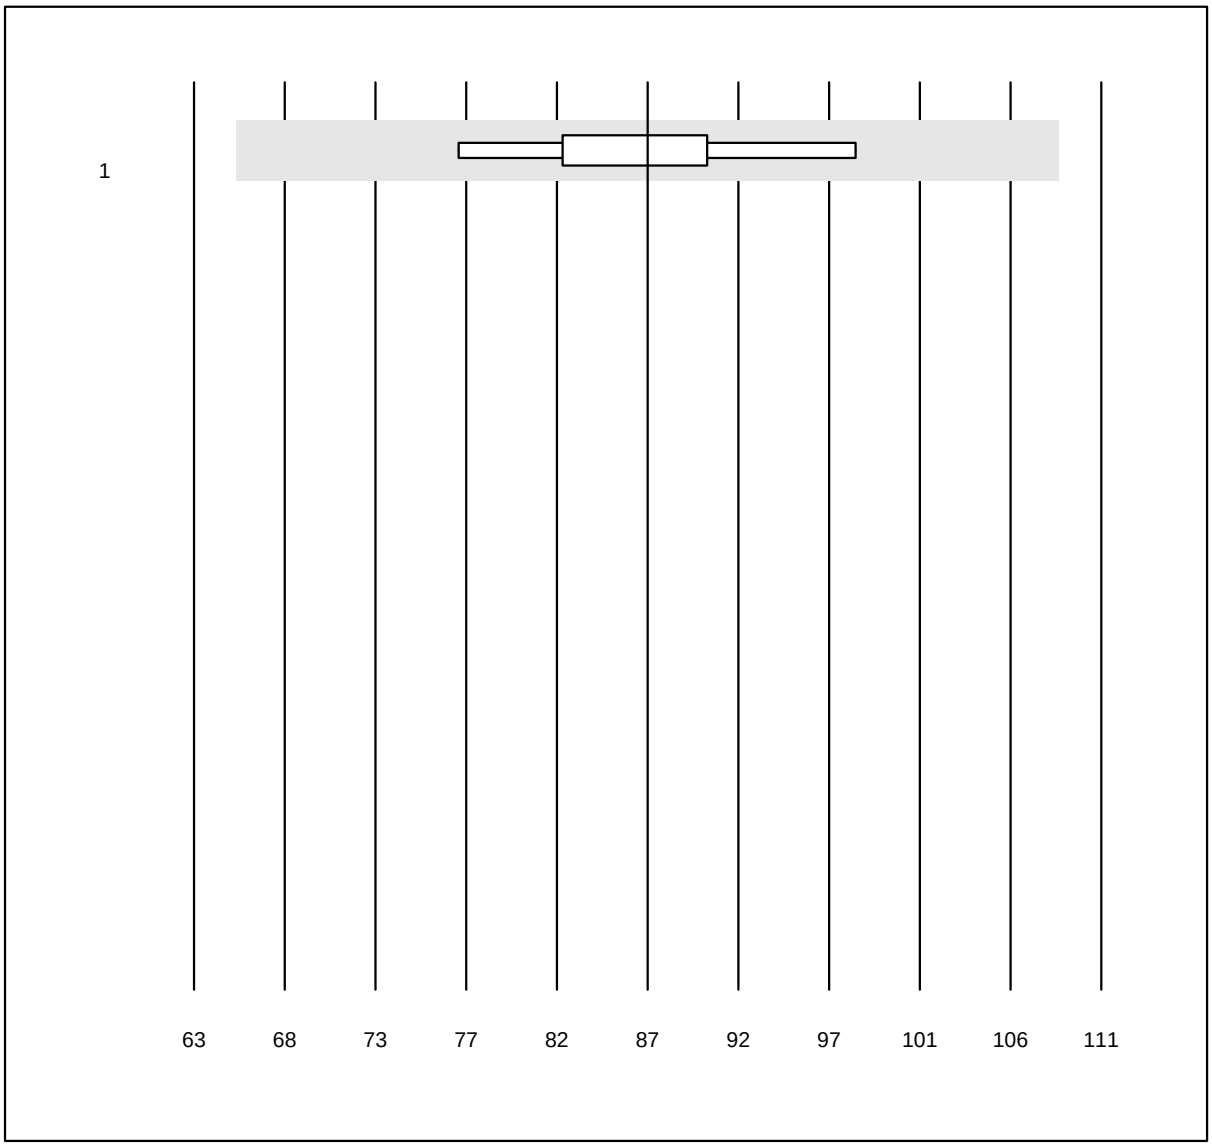


MQ Toleranz: 25%

Faktor V (%)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	toutes les méthodes	9	100.0	0.0	0.0	87.0	7.0	e

Faktor VII

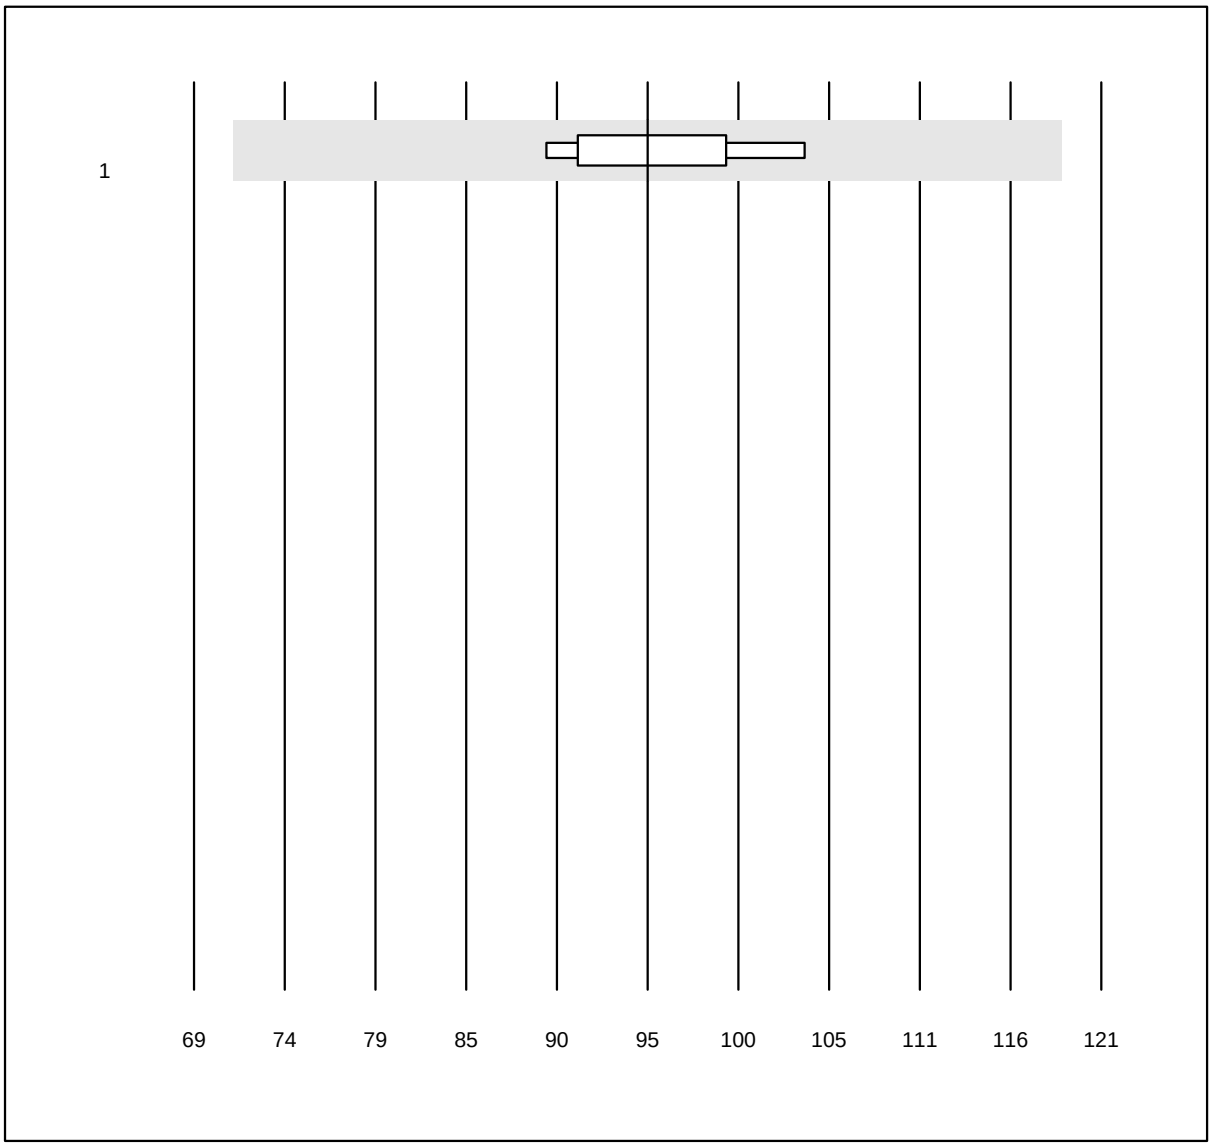


MQ Toleranz: 25%

Faktor VII (%)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	95.0	4.9	e

Thrombintemps N

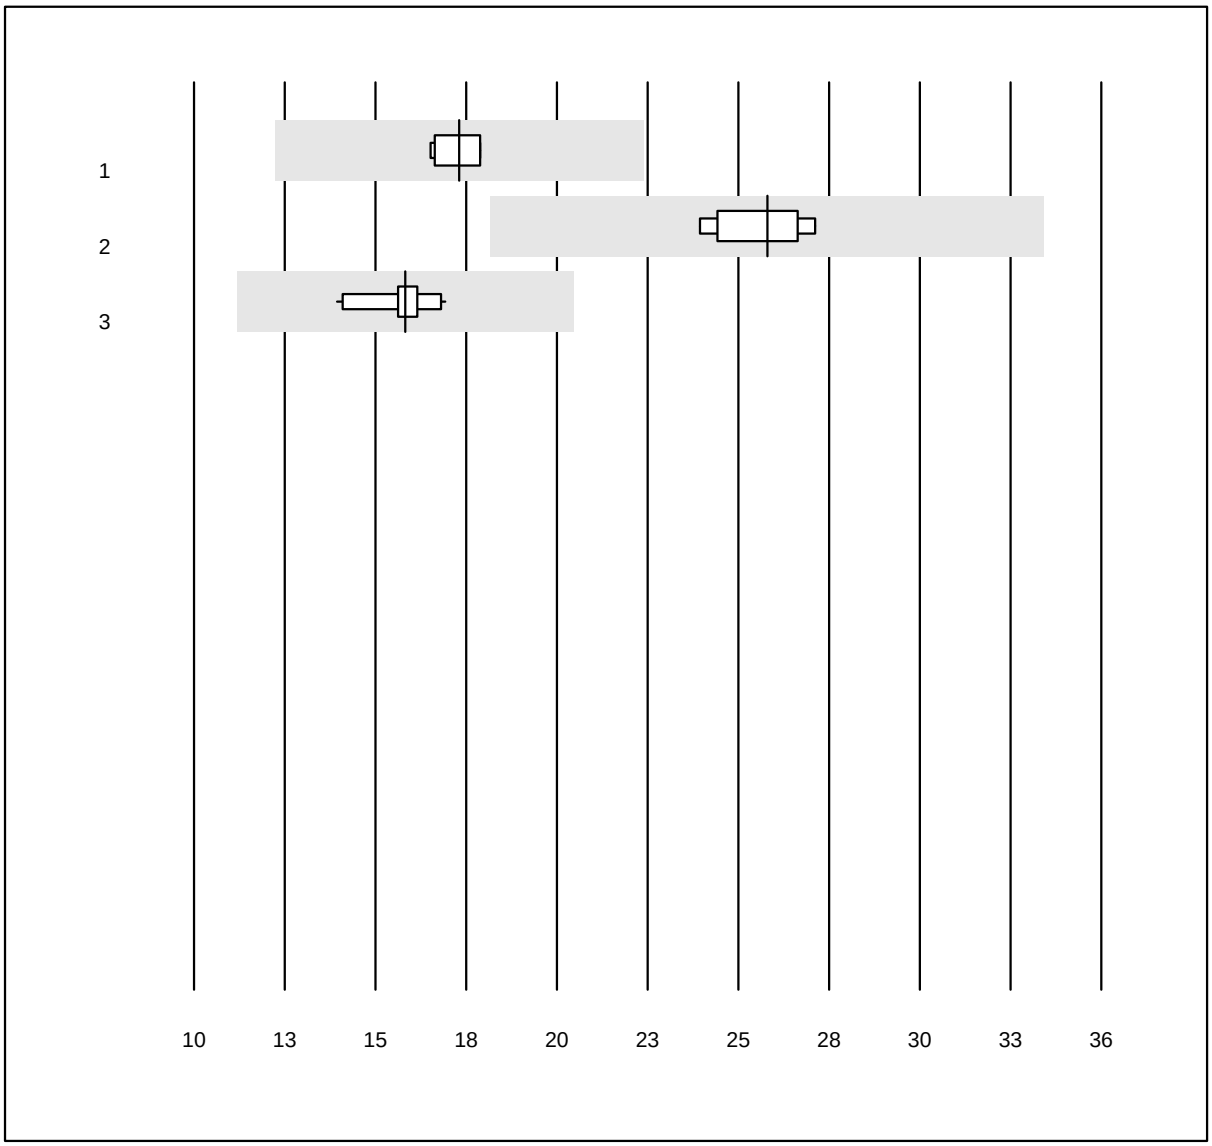


MQ Toleranz: 30%

Thrombintemps N (Sek)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Stago/STA	7	100.0	0.0	0.0	18	3.7	e
2	ACL	9	100.0	0.0	0.0	26	4.8	e
3	Autres méthodes	13	100.0	0.0	0.0	16	5.3	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

INR H

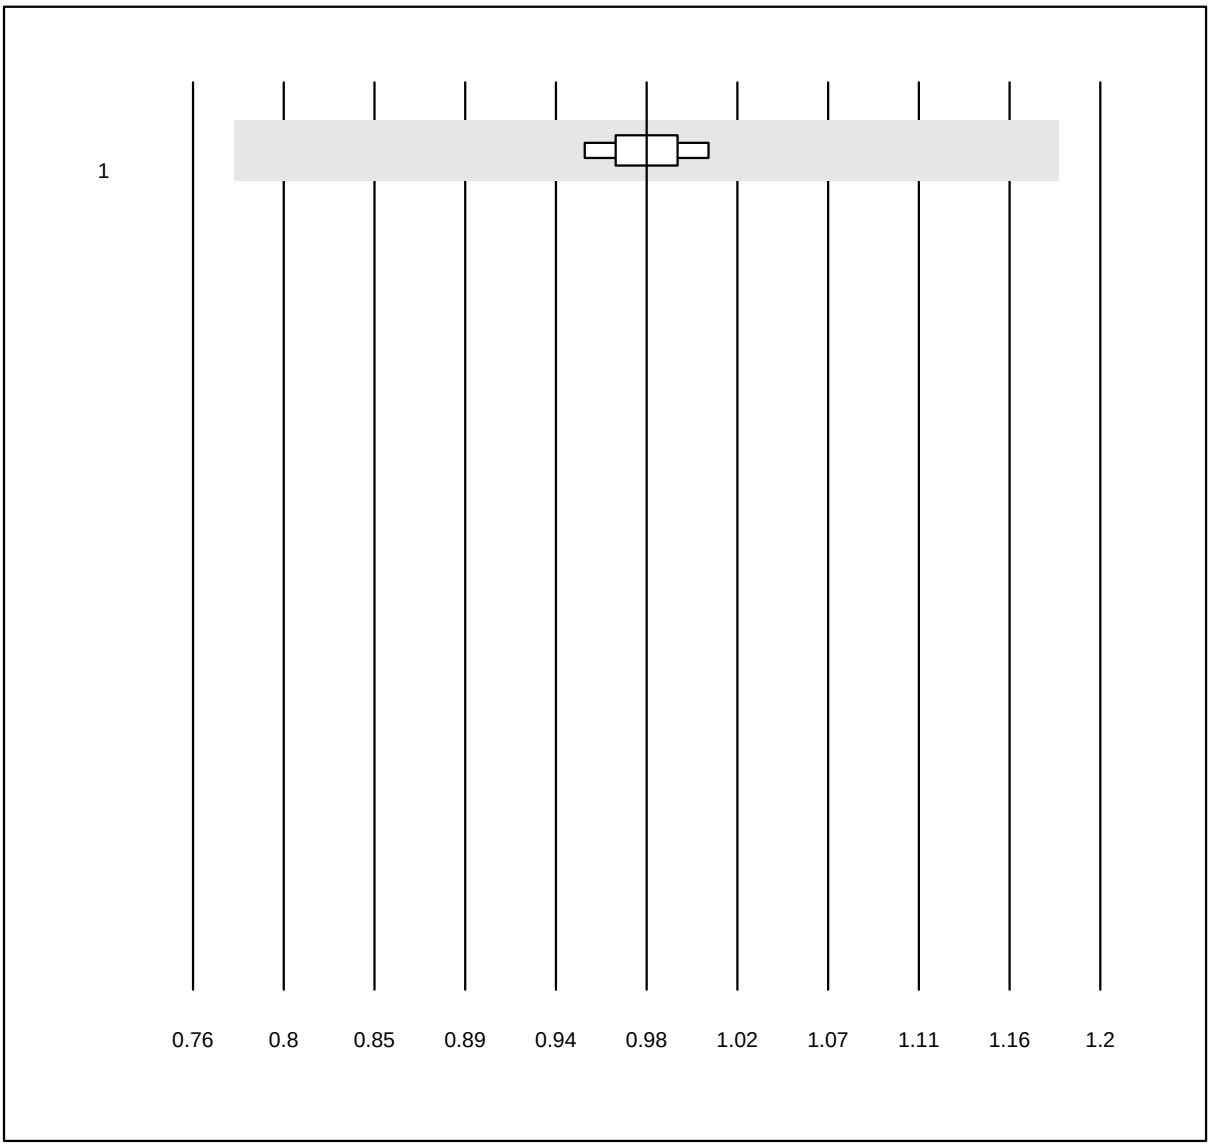


QUALAB Toleranz: 15%
(< 1.3: +/- 0.2 INR)

INR H (INR)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Innovin	4	100.0	0.0	0.0	0.98	1.7	e

4 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Quick H

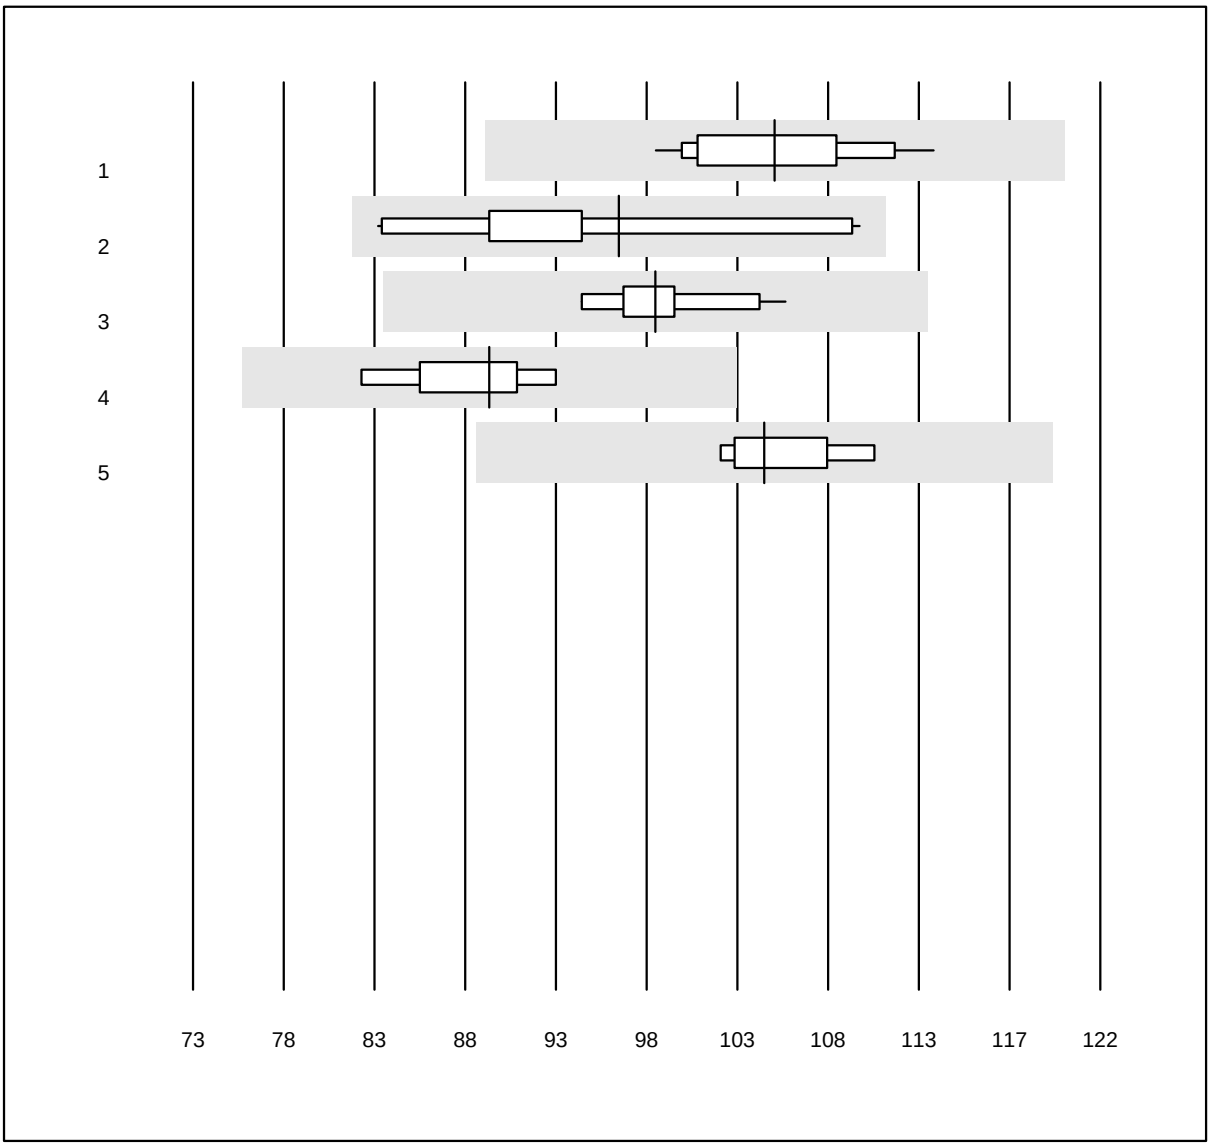


QUALAB Toleranz: 15%

Quick H (%)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Innovin	16	100.0	0.0	0.0	104.4	4.0	e
2	Neoplastin R	11	100.0	0.0	0.0	96.0	8.7	a*
3	Recombiplastin 2G	16	100.0	0.0	0.0	98.0	3.3	e
4	NeoPTimal	6	100.0	0.0	0.0	89.0	3.6	e
5	Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	103.8	2.6	e

aPTT H

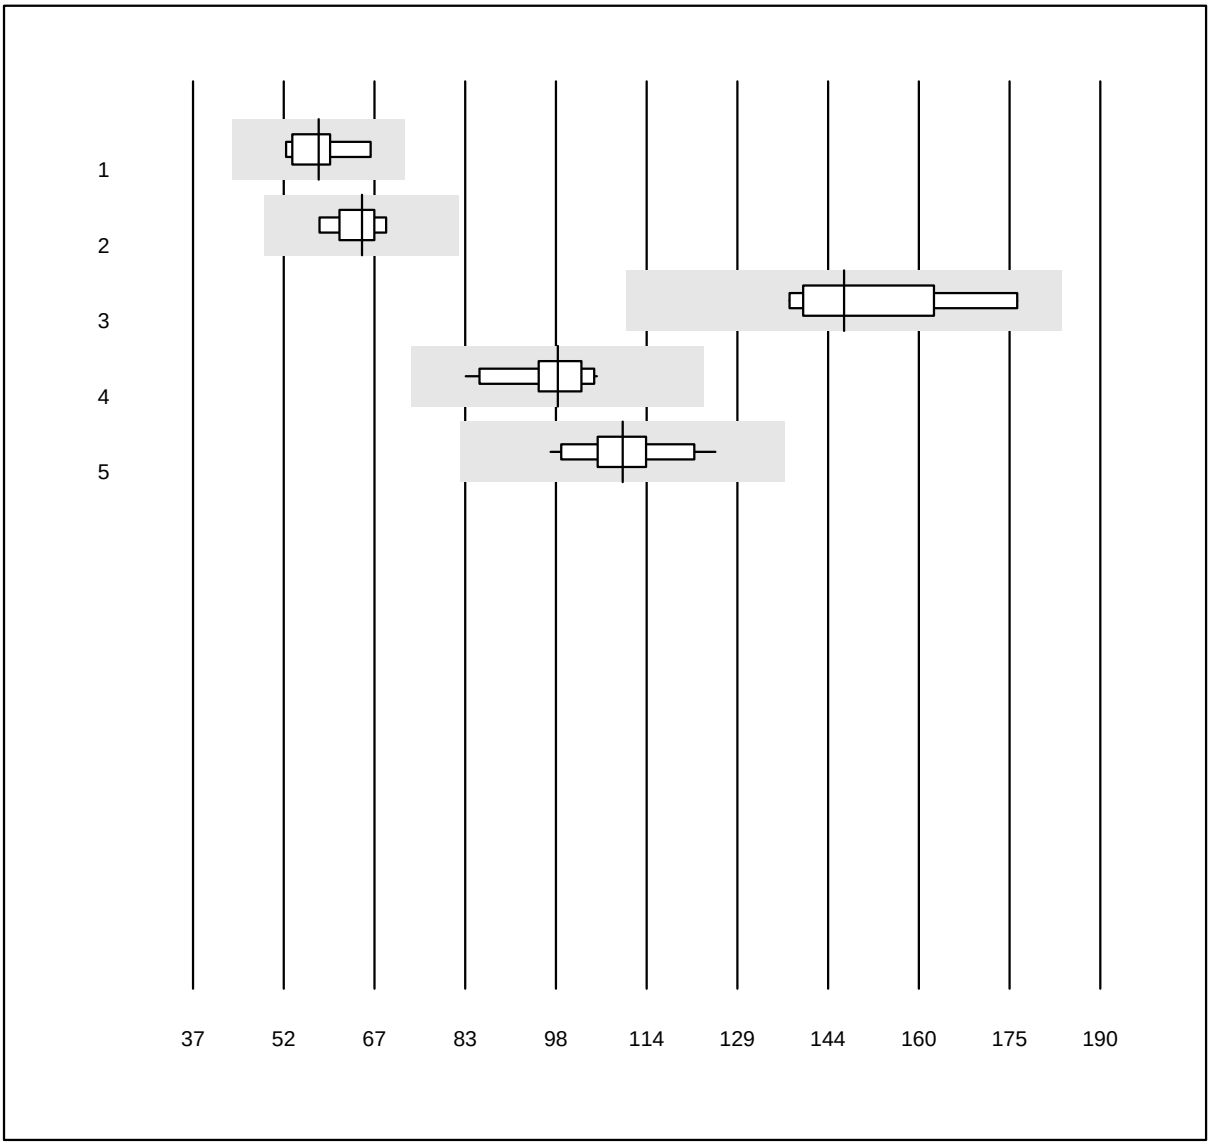


QUALAB Toleranz: 25%

aPTT H (Sek)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Actin FS	6	100.0	0.0	0.0	58.2	7.3	e
2	Actin FSL	6	100.0	0.0	0.0	65.5	5.5	e
3	Pathromtin SL	9	100.0	0.0	0.0	146.8	9.1	e*
4	aPTT-SP	11	100.0	0.0	0.0	98.5	6.1	e
5	Stago/STA	14	100.0	0.0	0.0	109.5	6.7	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Fibrinogène H

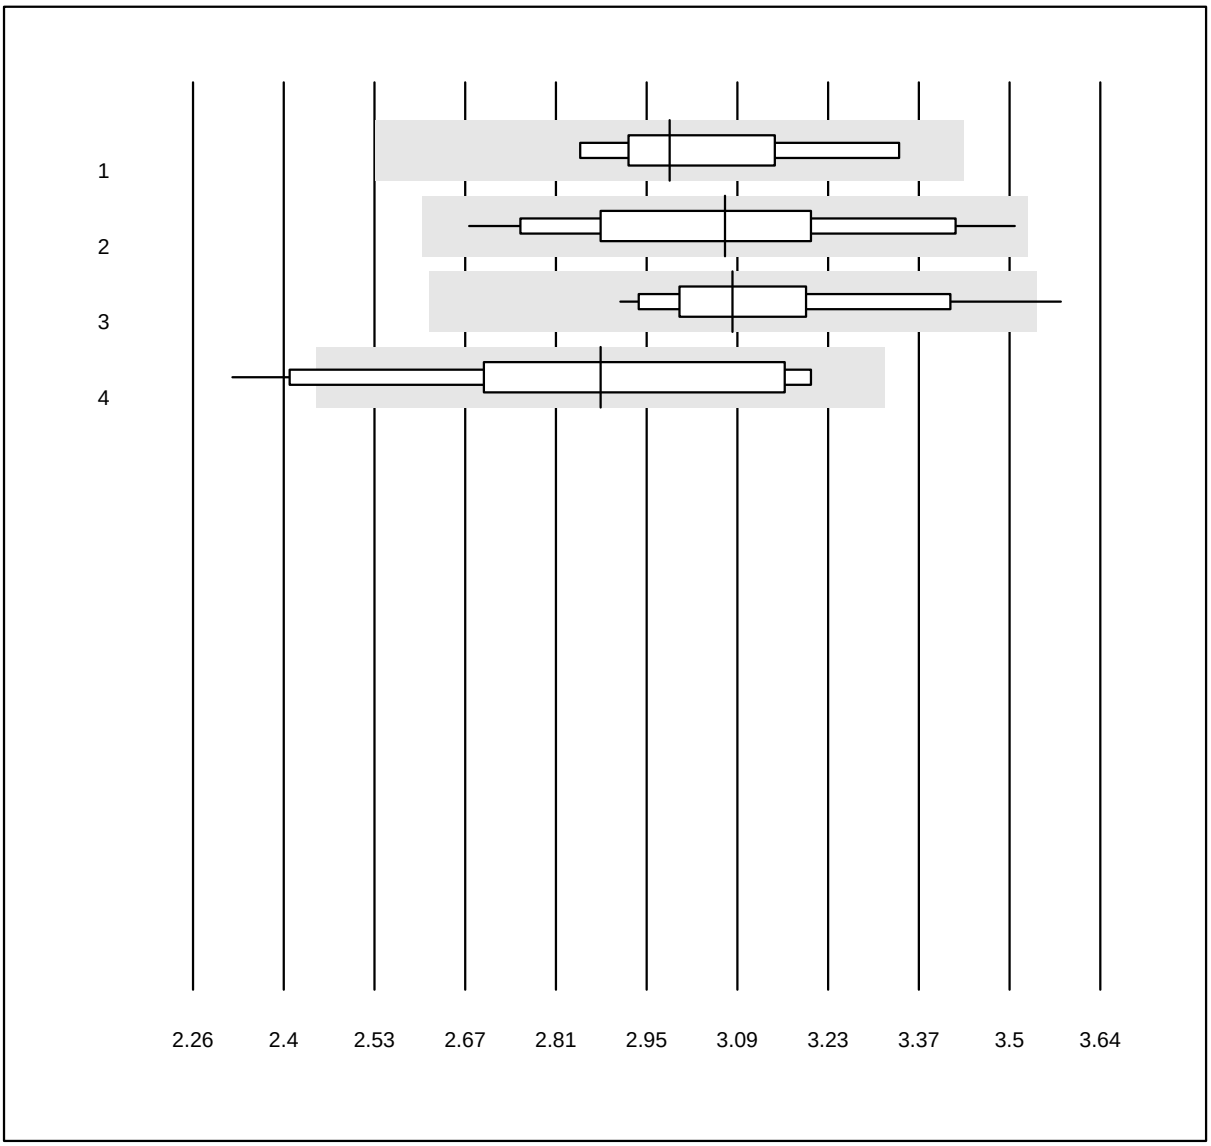


QUALAB Toleranz: 15%

Fibrinogène H (g/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Siemens Thrombin	6	100.0	0.0	0.0	2.98	4.8	e*
2	Stago/STA	15	100.0	0.0	0.0	3.07	7.0	e*
3	HemosIL	16	93.8	6.2	0.0	3.08	5.5	e
4	Autres méthodes	12	91.7	8.3	0.0	2.88	9.6	a*

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Thrombintemps H

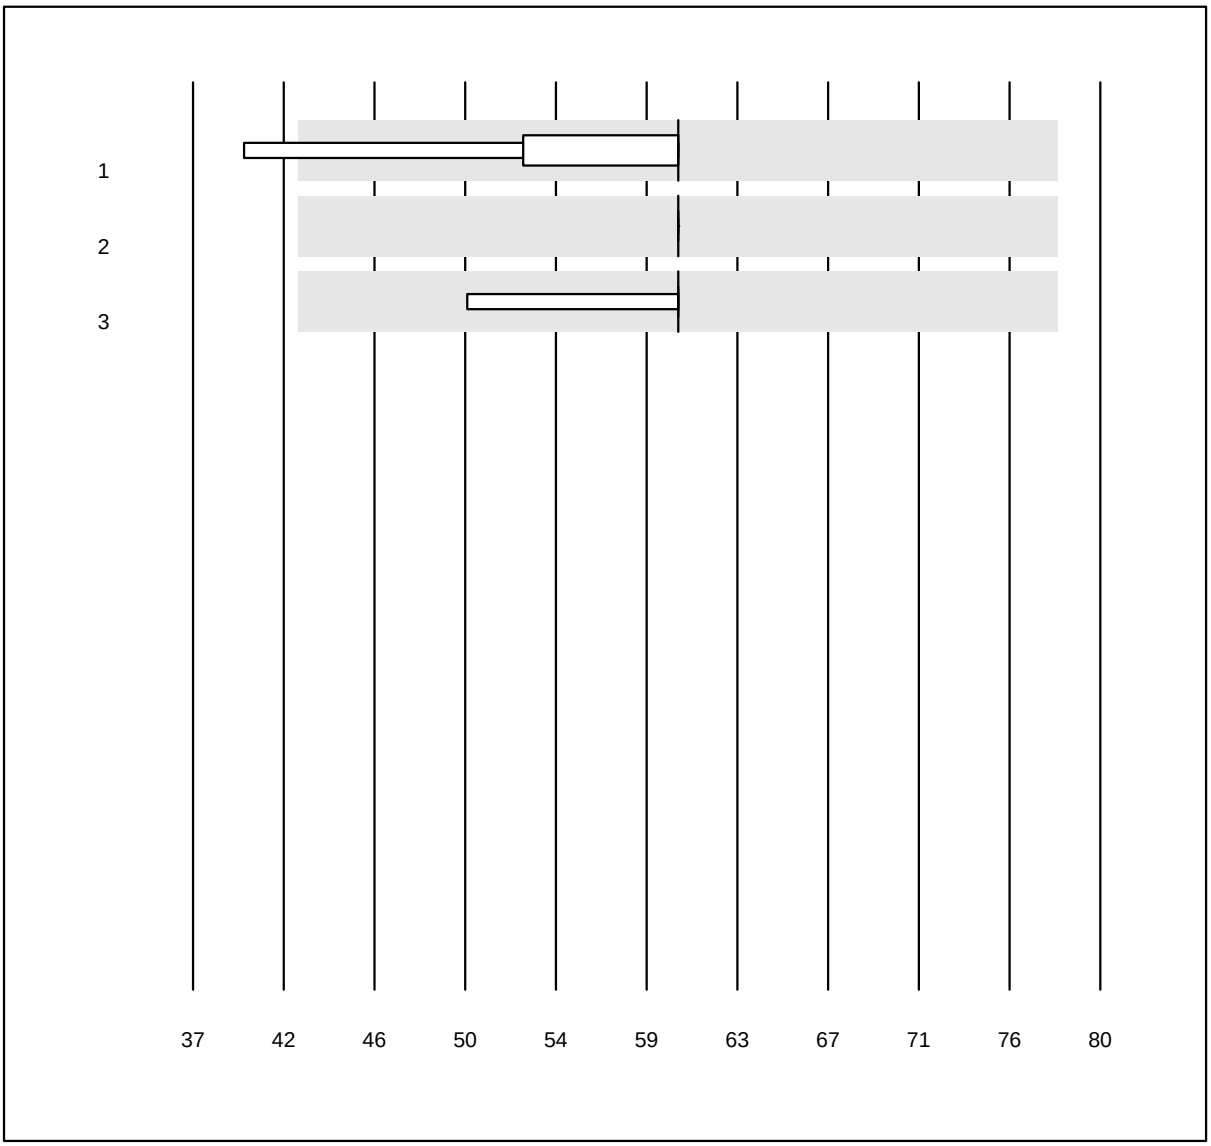


MQ Toleranz: 30%

Thrombintemps H (Sek)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Stago/STA	5	100.0	0.0	0.0	60	11.5	e*
2	ACL	8	100.0	0.0	0.0	60	0.0	e
3	Autres méthodes	11	100.0	0.0	0.0	60	7.0	e

Anti-FXa (unfrakt-Heparin)

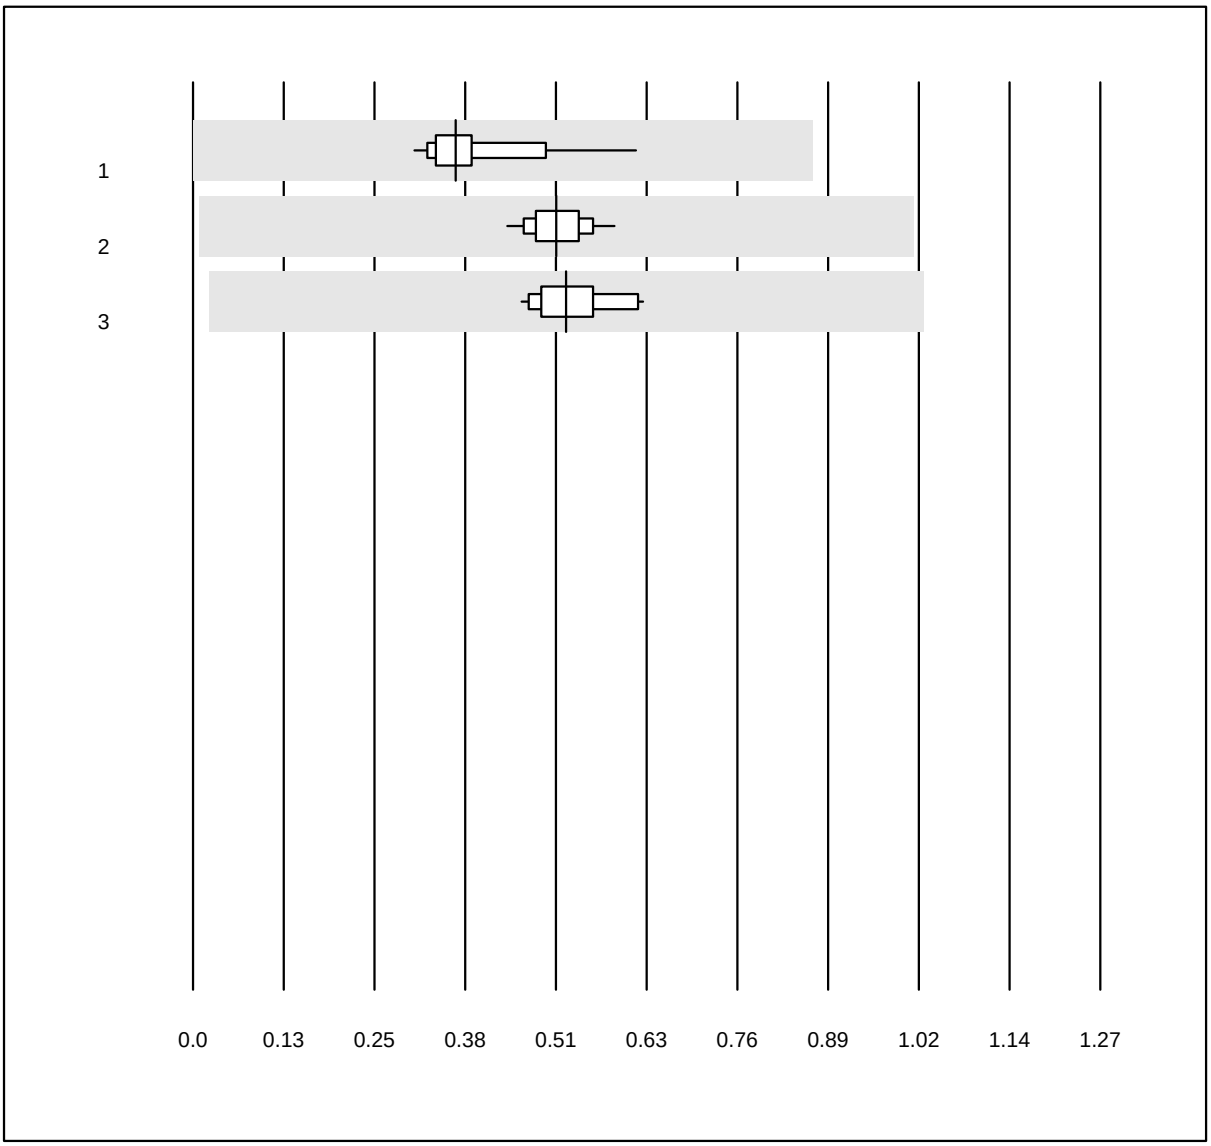


MQ Toleranz: 30%
(< 0.9: +/- 0.5 IU/ml)

Anti-FXa (unfrakt-Heparin)
(IU/ml)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Stago/STA	15	100.0	0.0	0.0	0.37	18.7	e
2	ACL	22	100.0	0.0	0.0	0.51	7.6	e
3	Autres méthodes	26	100.0	0.0	0.0	0.52	9.3	e

D-Dimères

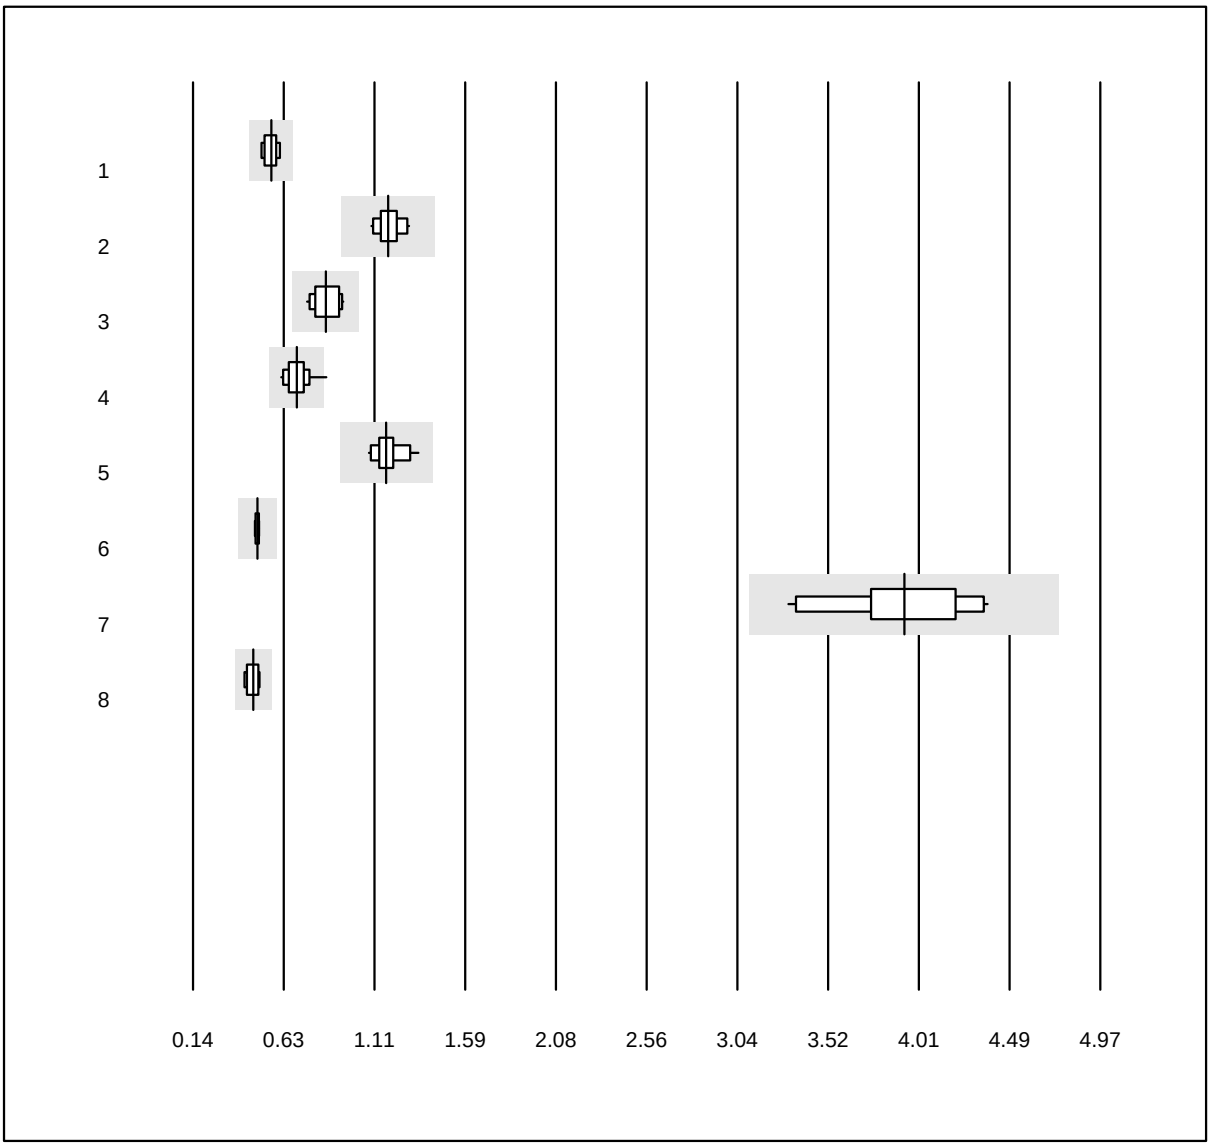


QUALAB Toleranz: 21%

D-Dimères (mg/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	5	100.0	0.0	0.0	0.56	6.0	e*
2	Siemens	18	100.0	0.0	0.0	1.18	5.0	e
3	VIDAS	16	93.8	0.0	6.2	0.85	7.4	e
4	STA Liatest	19	94.7	5.3	0.0	0.69	8.3	e
5	ACL	13	100.0	0.0	0.0	1.17	5.7	e
6	AQT 90 FLEX	4	100.0	0.0	0.0	0.48	2.0	e
7	Pathfast	19	100.0	0.0	0.0	3.93	8.4	e
8	Roche (plasma hépariné)	4	100.0	0.0	0.0	0.46	7.1	e*

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)


D-Dimères qn AFIAS

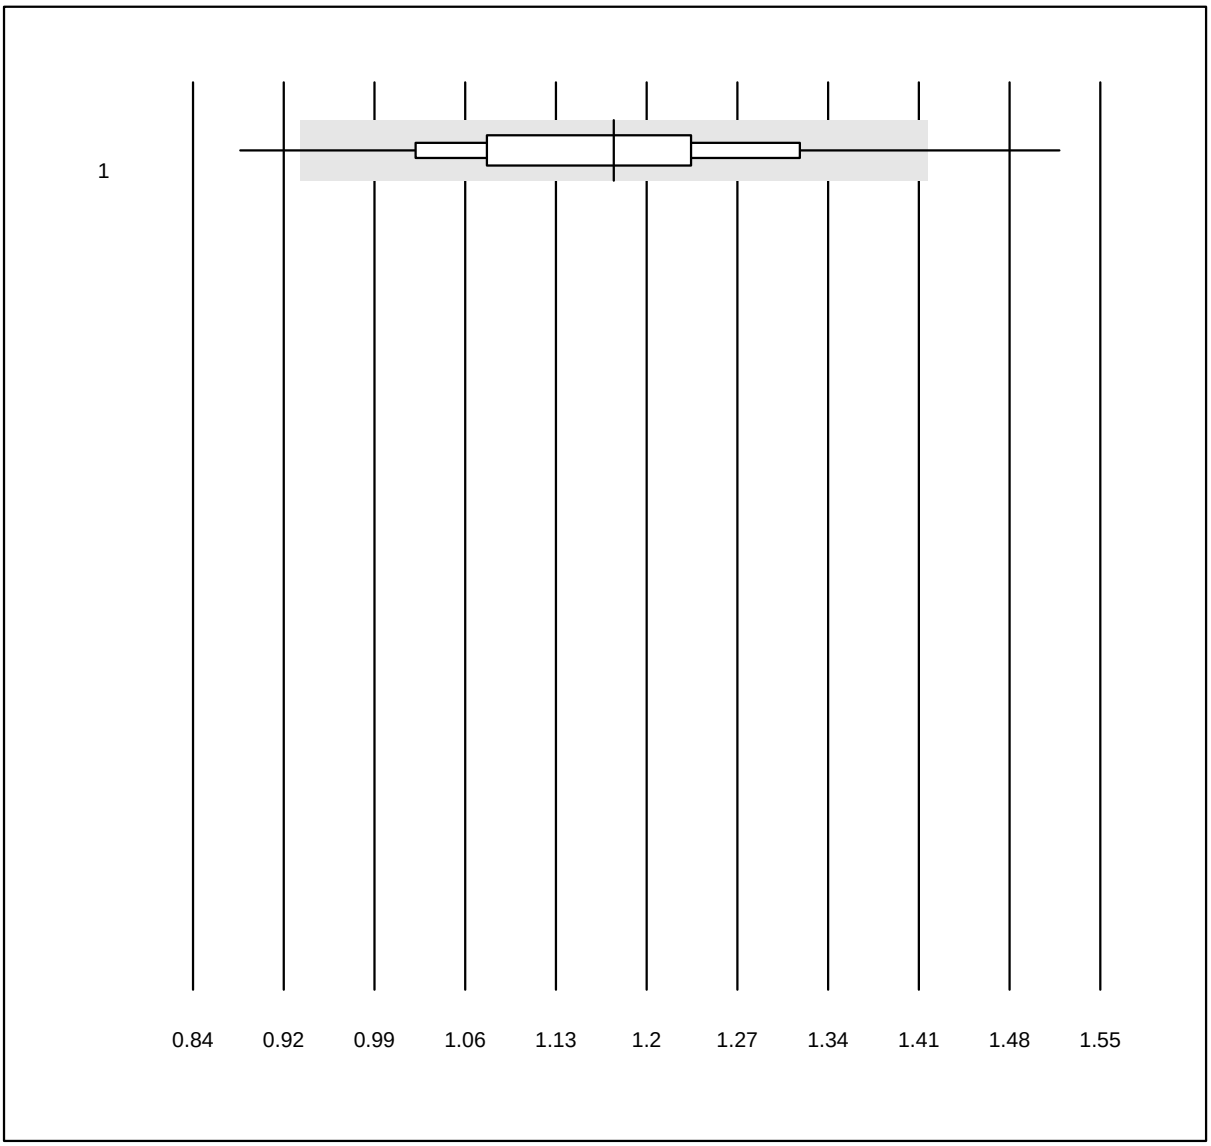

QUALAB Toleranz: 21% D-Dimères qn AFIAS (mg/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	AFIAS	676	88.2	3.6	8.3	1.17	10.2	e

D-Dimere Triage

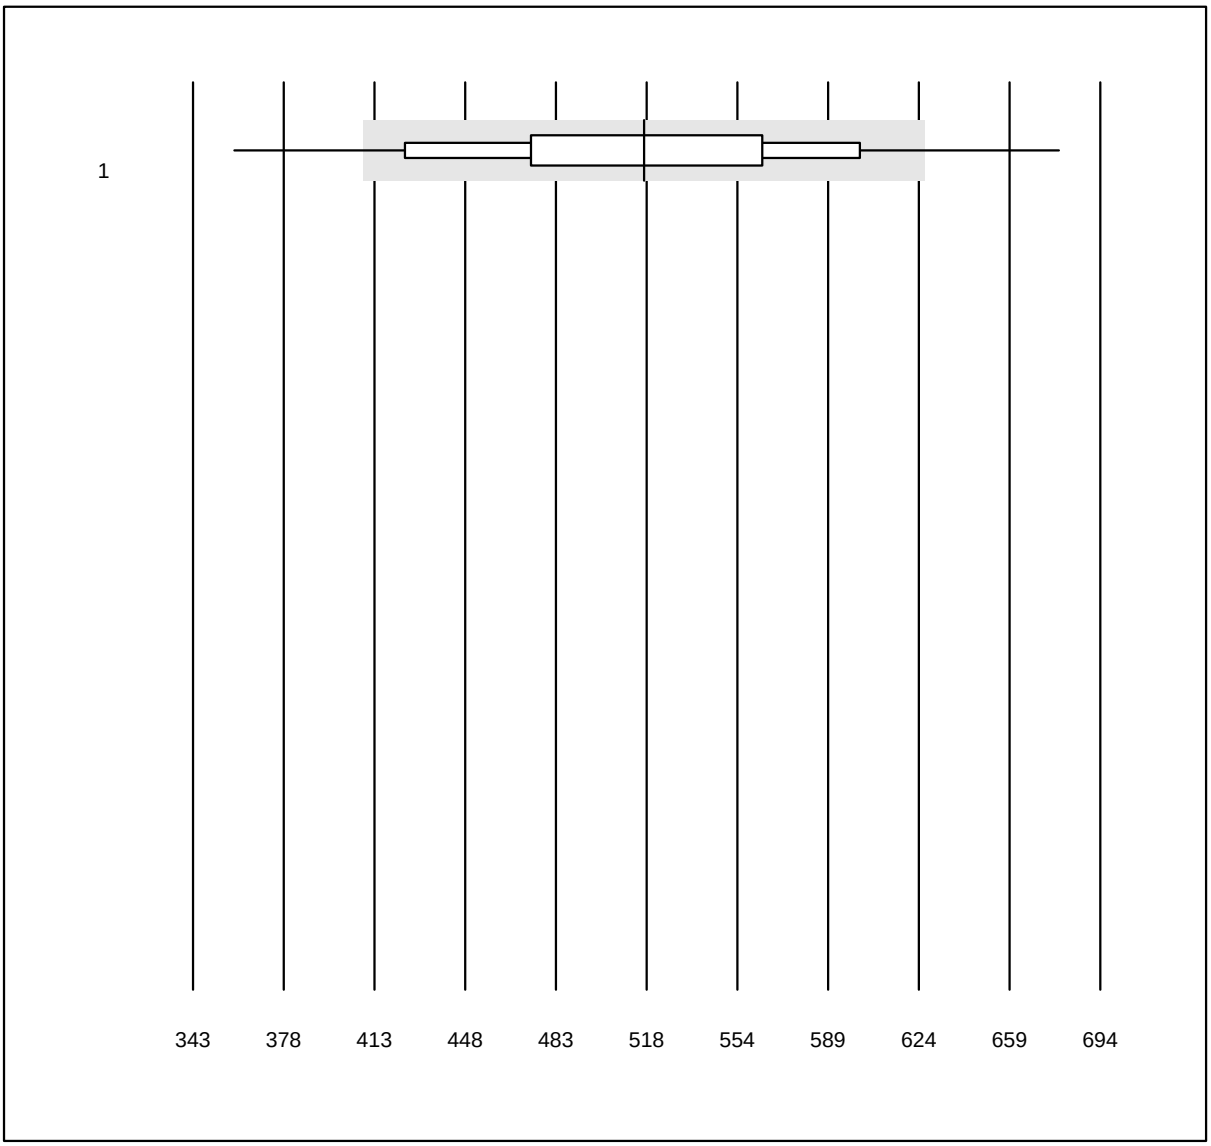


QUALAB Toleranz: 21%

D-Dimere Triage (ng/ml)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Triage	472	88.8	10.0	1.3	517.51	12.6	e

CoaguChek APTT

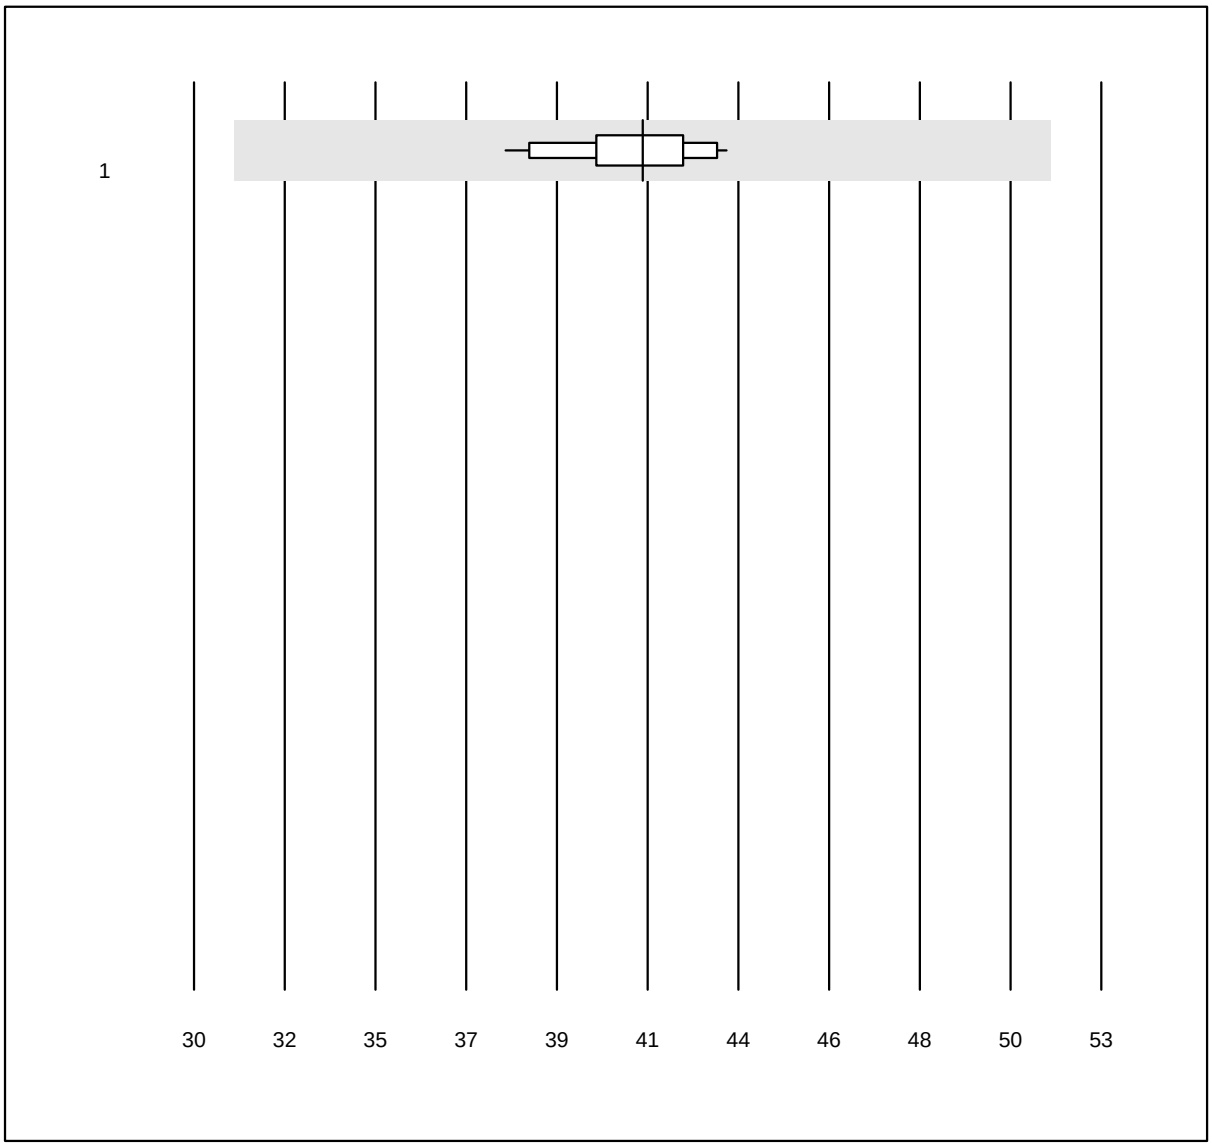


QUALAB Toleranz: 25%

CoaguChek APTT (Sek)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	CoaguChek Pro II	12	100.0	0.0	0.0	41.4	3.7	e

INR CCXS

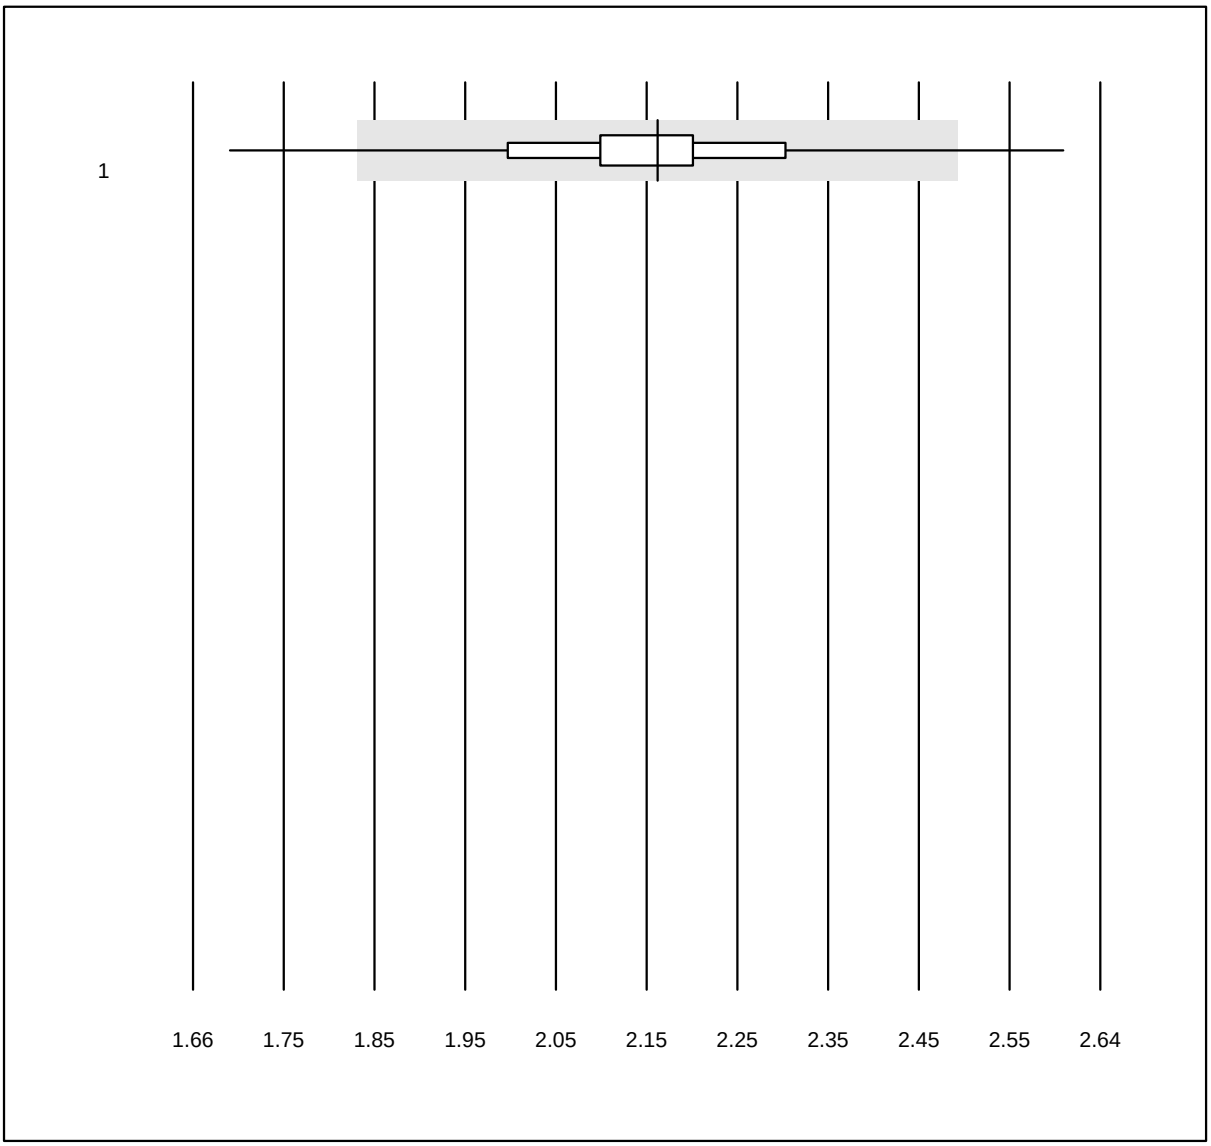


QUALAB Toleranz: 15%

INR CCXS (INR)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	CoaguChek XS	1083	98.9	0.6	0.5	2.2	4.3	e


INR HC

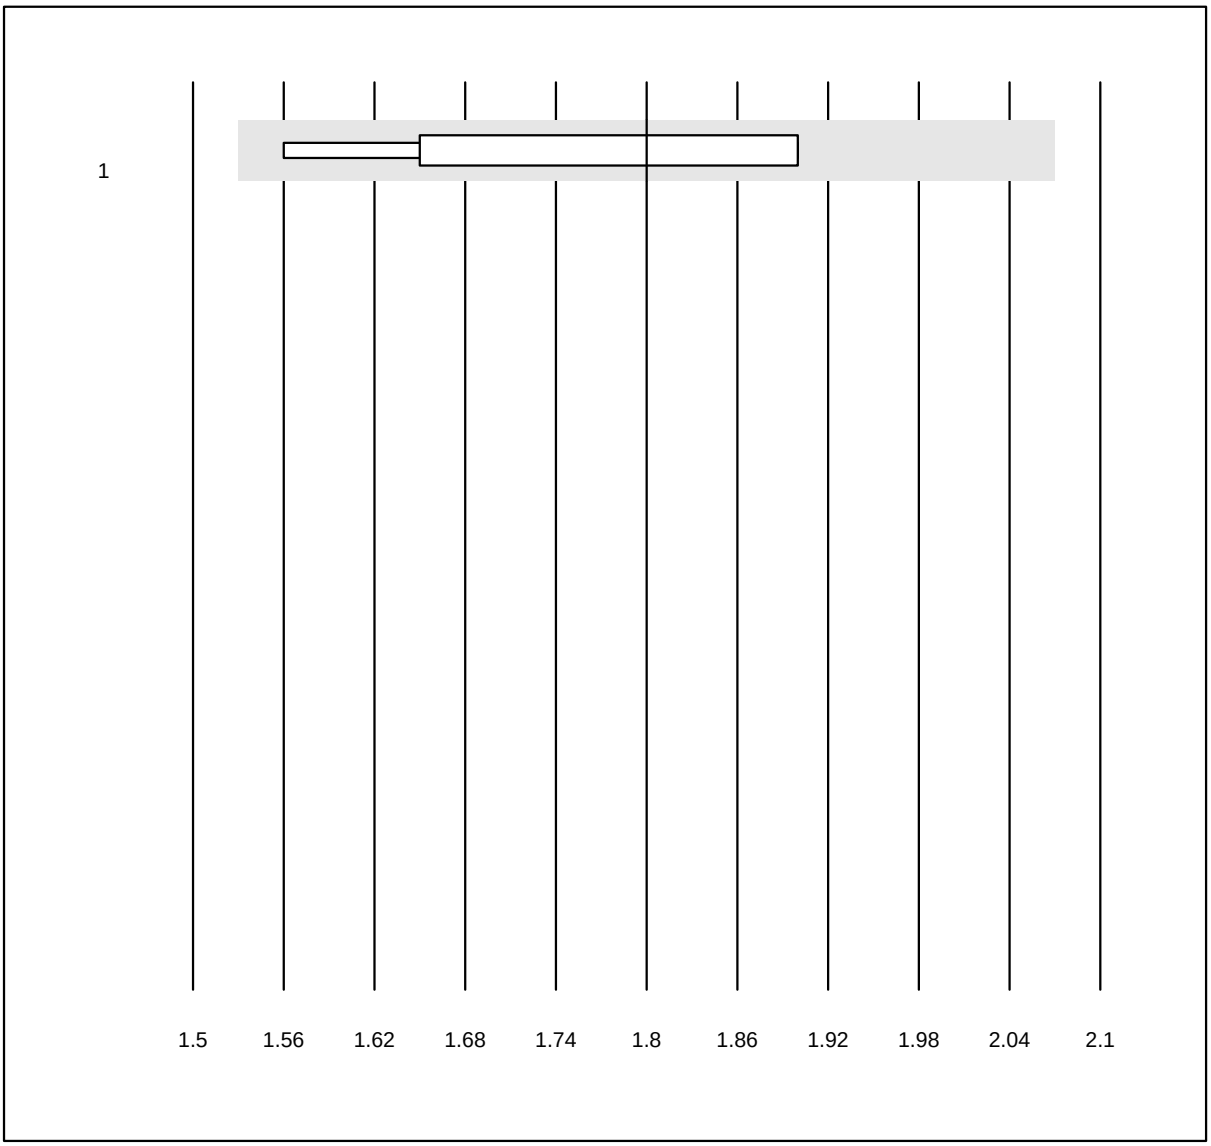

QUALAB Toleranz: 15% INR HC ()

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Hemochron j.	5	100.0	0.0	0.0	1.8	7.3	e*

INR MI

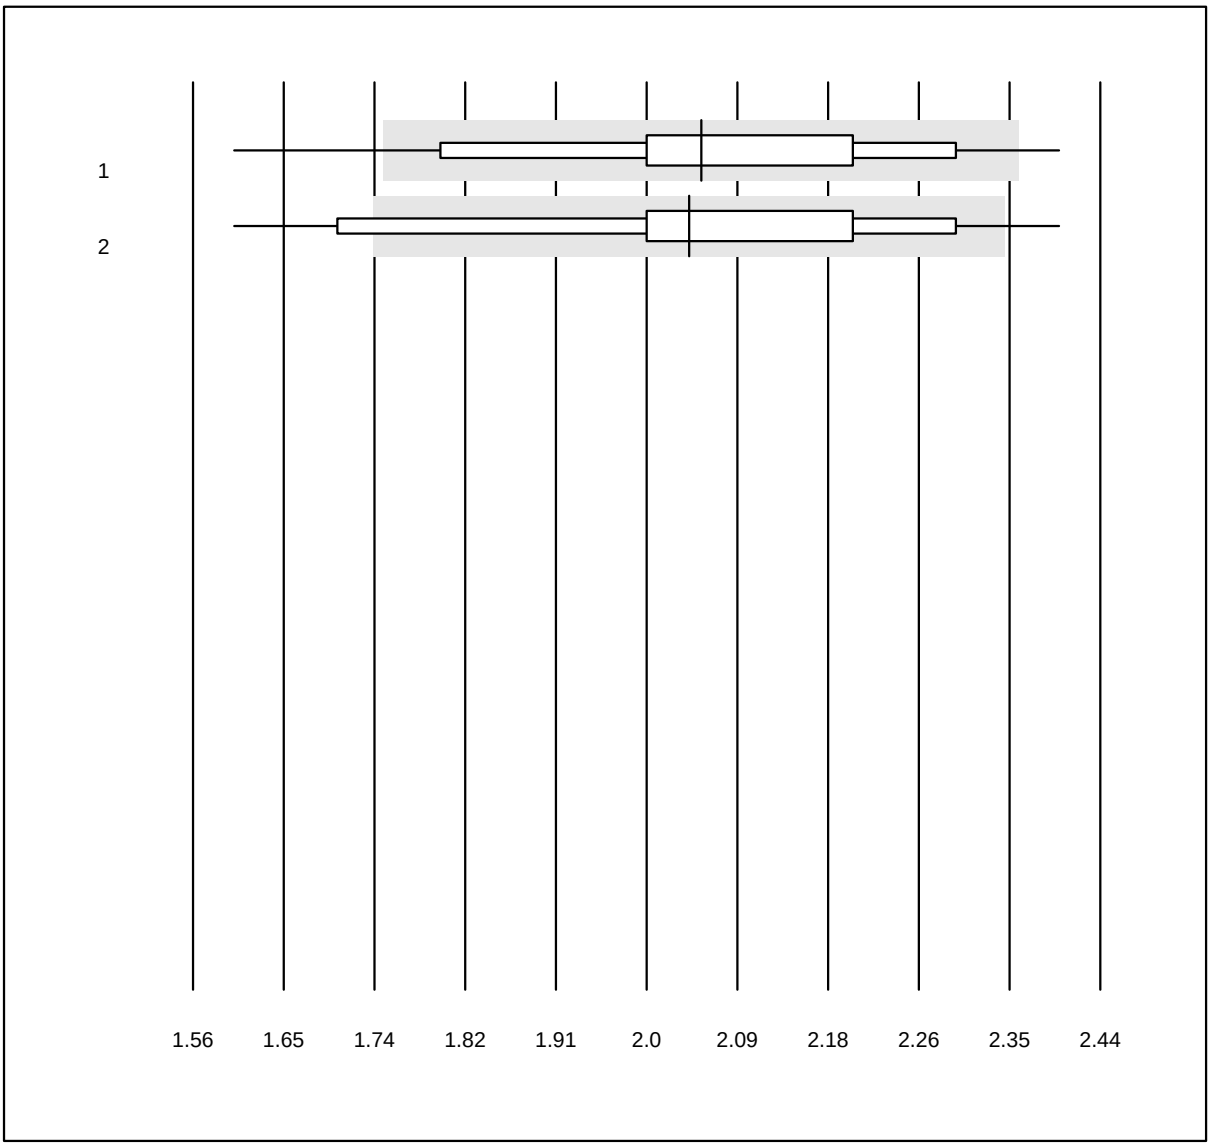


QUALAB Toleranz: 15%

INR MI ()

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	microINR Expert	54	85.2	5.6	9.3	2.1	8.5	e
2	microINR	98	72.4	13.3	14.3	2.0	9.5	e

INR Lumira Dx

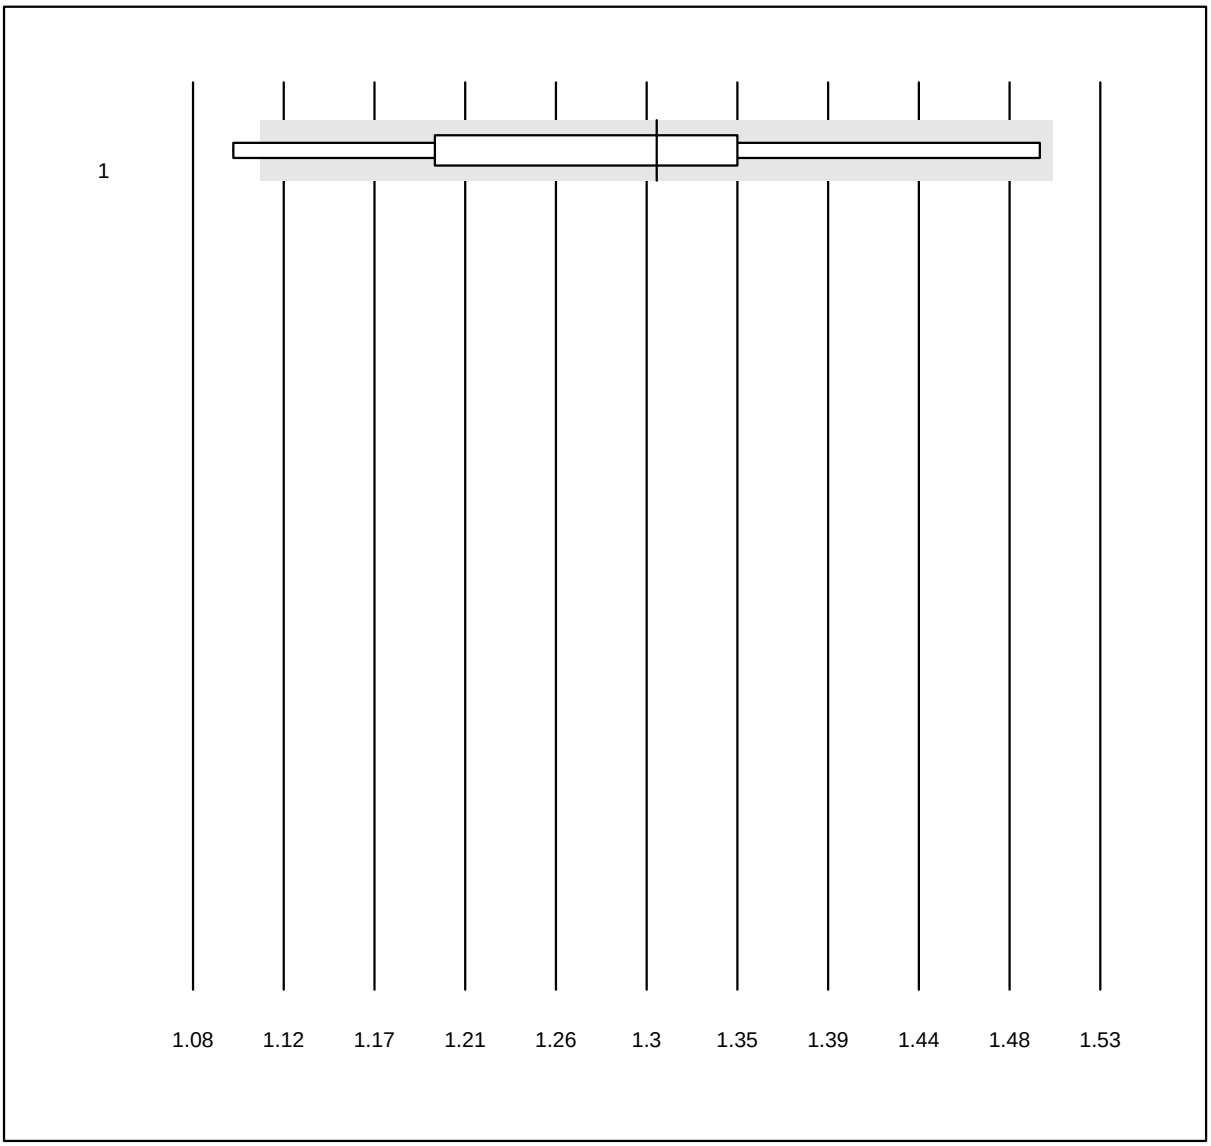


QUALAB Toleranz: 15%

INR Lumira Dx ()

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Lumira Dx	10	80.0	10.0	10.0	1.3	9.4	a*

Anti-FXa (LMW-Heparin)

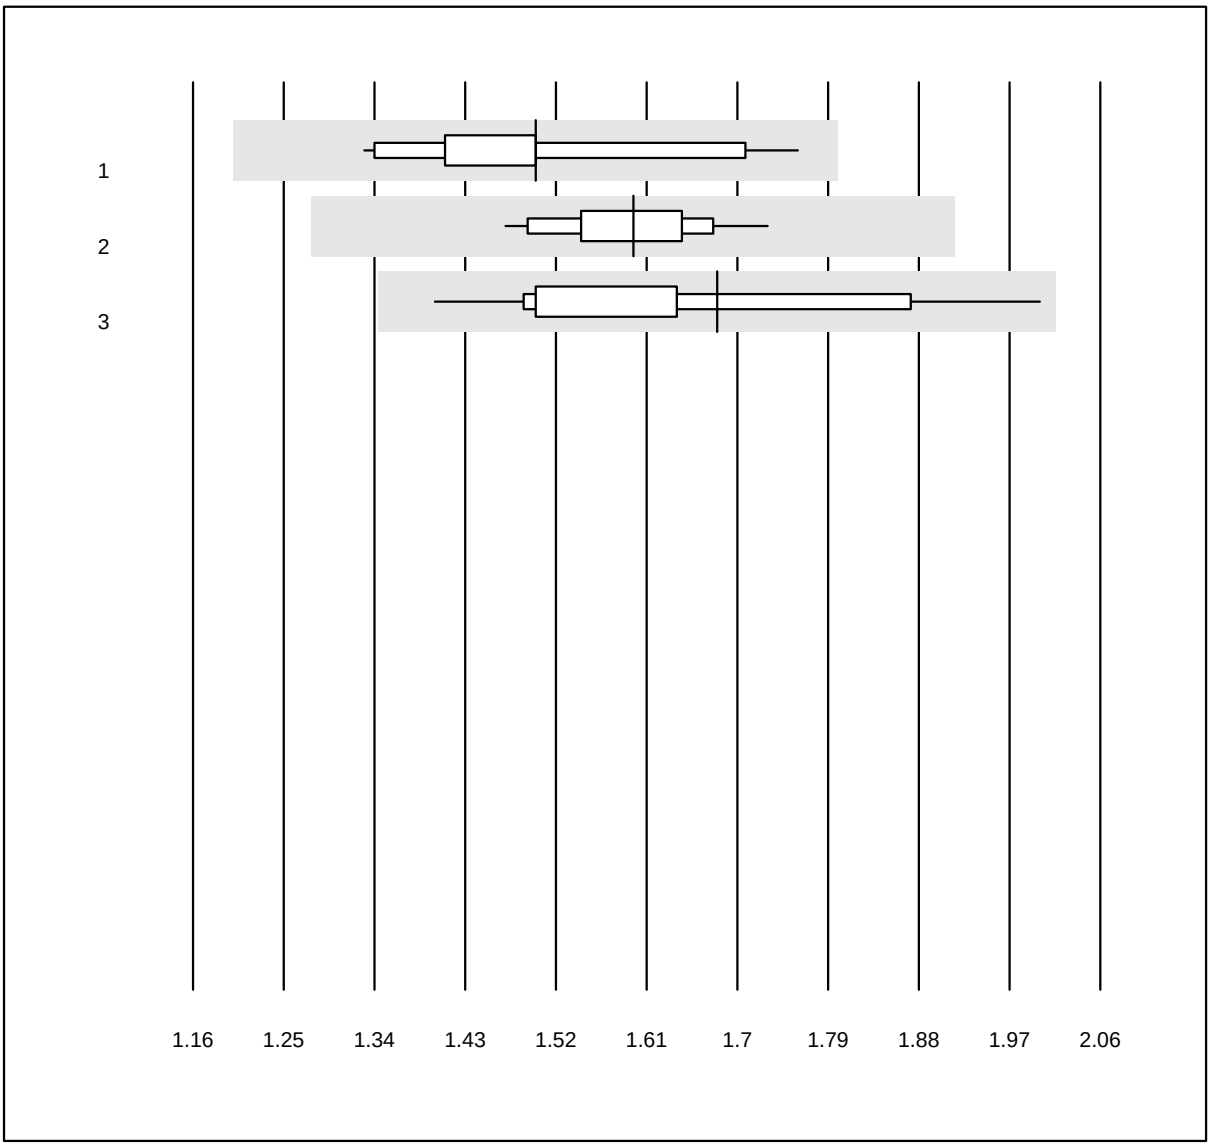


MQ Toleranz: 20%

Anti-FXa (LMW-Heparin)
(IU/ml)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Stago/STA	11	100.0	0.0	0.0	1.50	7.5	a
2	ACL	21	100.0	0.0	0.0	1.60	4.2	e
3	Autres méthodes	23	100.0	0.0	0.0	1.68	9.5	a

Anti-FXa (Rivaroxaban)

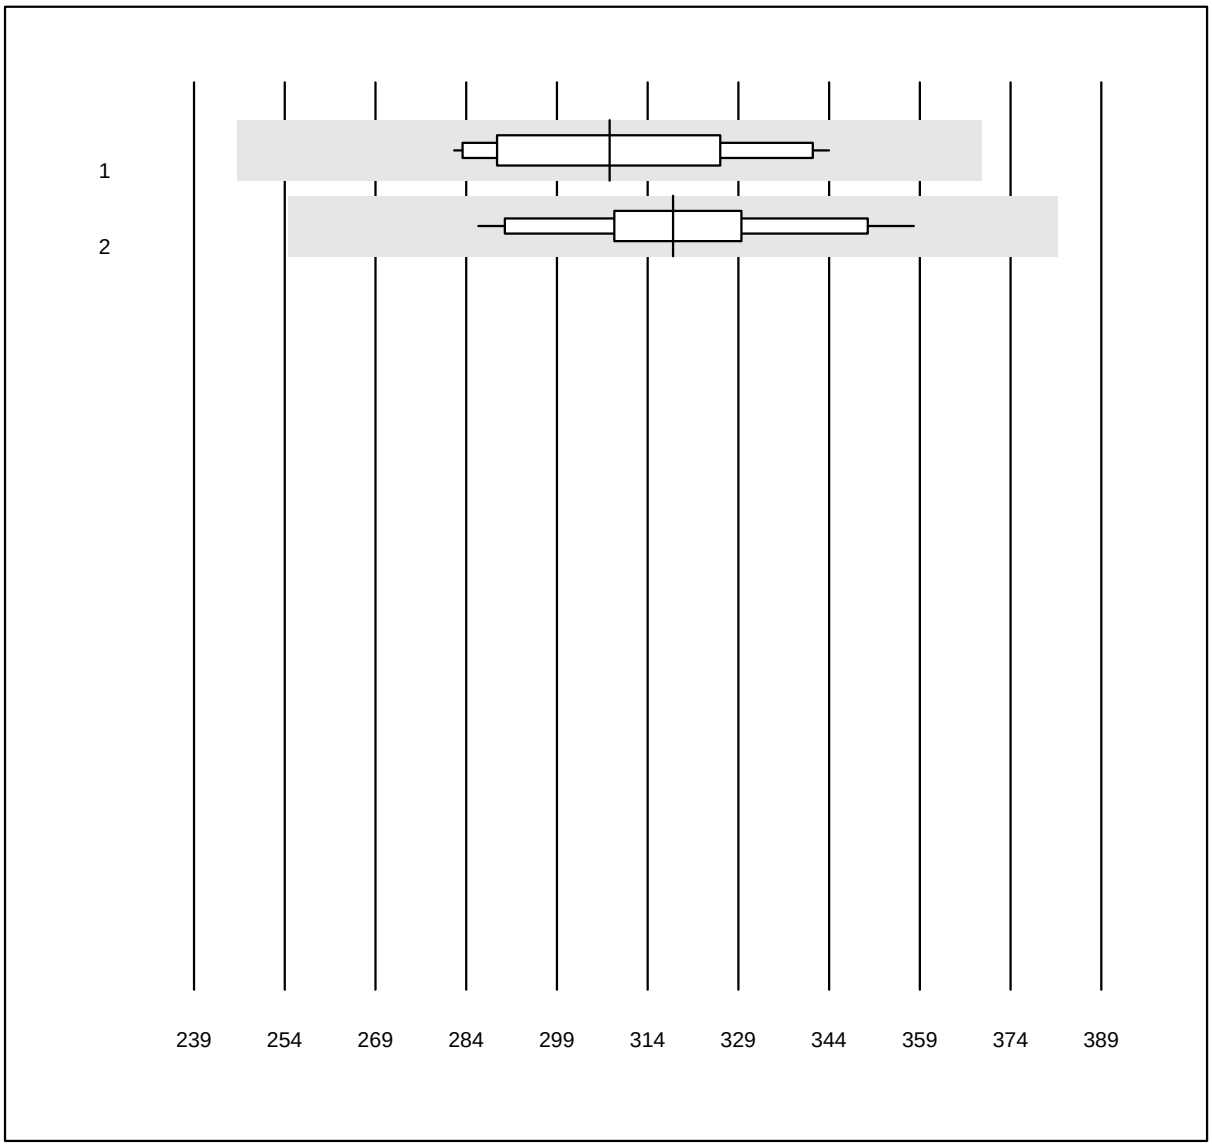


MQ Toleranz: 20%

Anti-FXa (Rivaroxaban)
(µg/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	ACL	11	100.0	0.0	0.0	307.72	6.6	e
2	Stago/STA	13	100.0	0.0	0.0	318.21	5.8	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Anti-FXa (Apixaban)

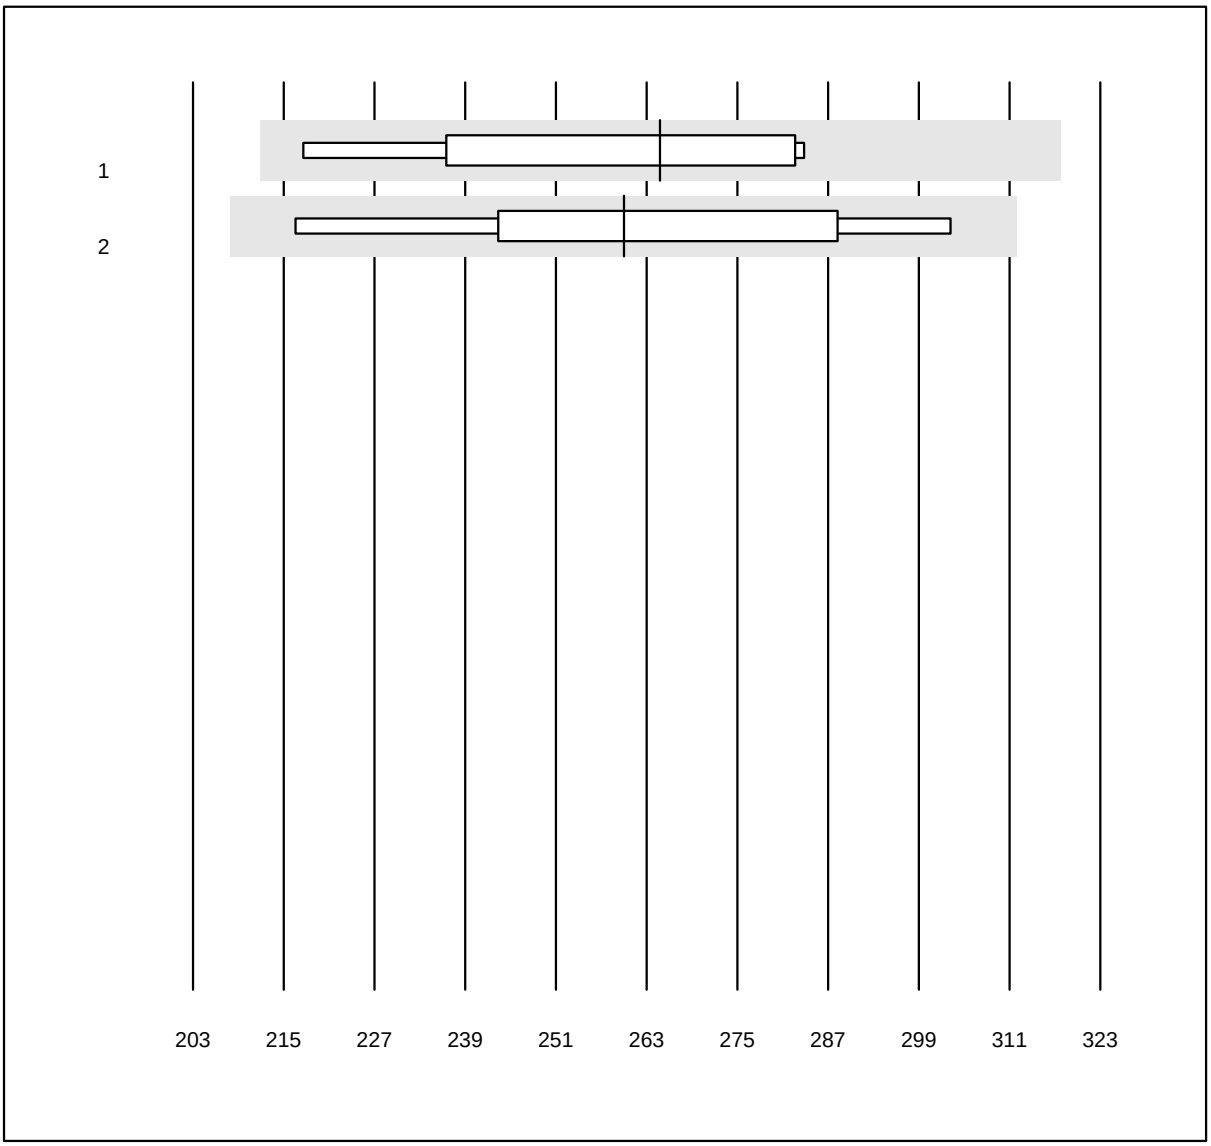


MQ Toleranz: 20%

Anti-FXa (Apixaban) (µg/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	ACL	5	100.0	0.0	0.0	264.77	9.4	e*
2	Stago/STA	8	100.0	0.0	0.0	260.00	10.6	a*

Hémoglobine 1

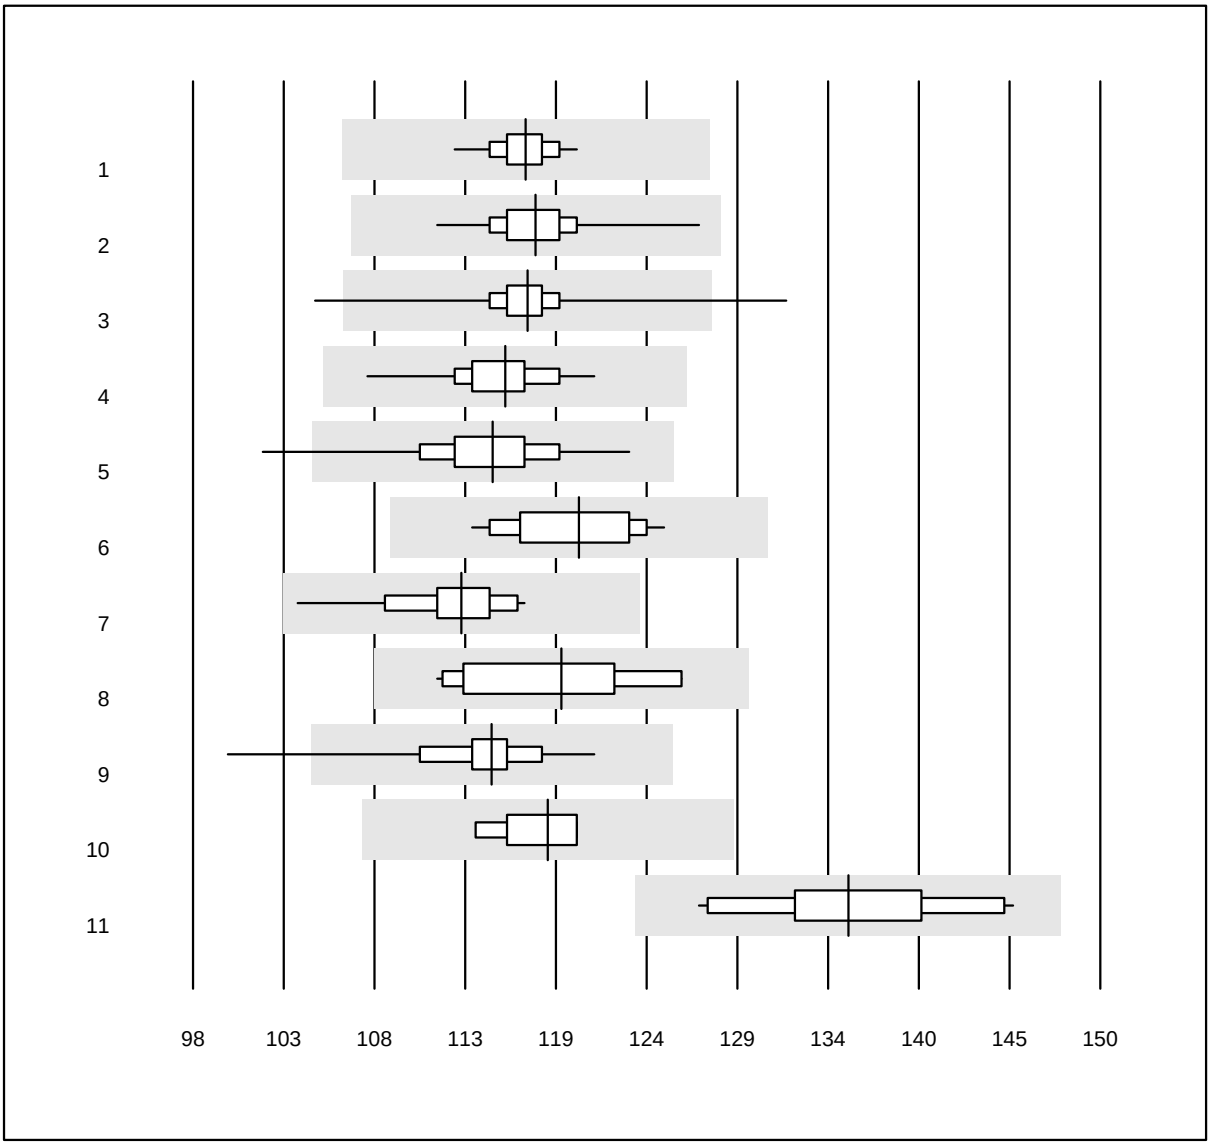


QUALAB Toleranz: 9%

Hémoglobine (g/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Sysmex XN	58	100.0	0.0	0.0	117.1	1.3	e
2	Sysmex XQ-320	297	98.7	0.0	1.3	117.6	1.6	e
3	Sysmex XP-300	477	97.3	1.3	1.5	117.2	2.1	e
4	Sysmex PocH-100i	174	98.9	0.0	1.1	115.9	2.1	e
5	Mythic	176	96.6	0.6	2.8	115.2	2.8	e
6	Swelab	14	100.0	0.0	0.0	120.1	2.7	e
7	Micros 60	34	97.1	0.0	2.9	113.4	2.6	e
8	DiaSpect	13	92.3	0.0	7.7	119.1	4.1	e*
9	Hemocue	372	94.6	1.9	3.5	115.1	2.6	e
10	Automate	5	100.0	0.0	0.0	118.3	1.8	e
11	Hemocue Hb 801	14	100.0	0.0	0.0	135.6	4.1	e*

4 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Hémoglobine 2

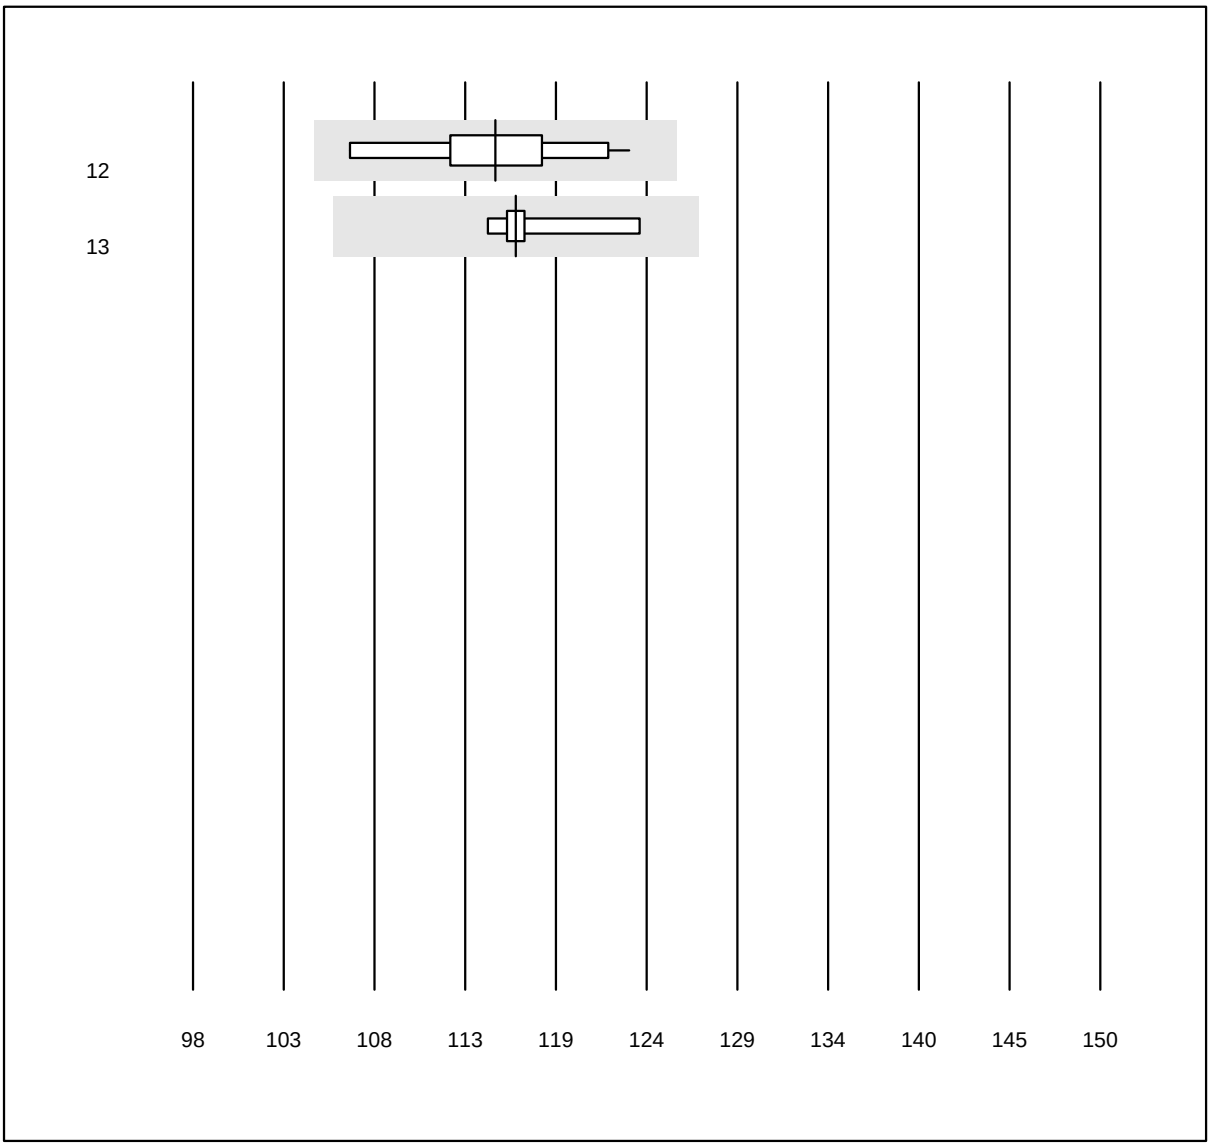


QUALAB Toleranz: 9%

Hémoglobine (g/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
12	Cyanmethémoglobine	12	100.0	0.0	0.0	115.3	4.1	e*
13	Hemocontrol	8	100.0	0.0	0.0	116.5	2.1	e

4 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Hématocrite

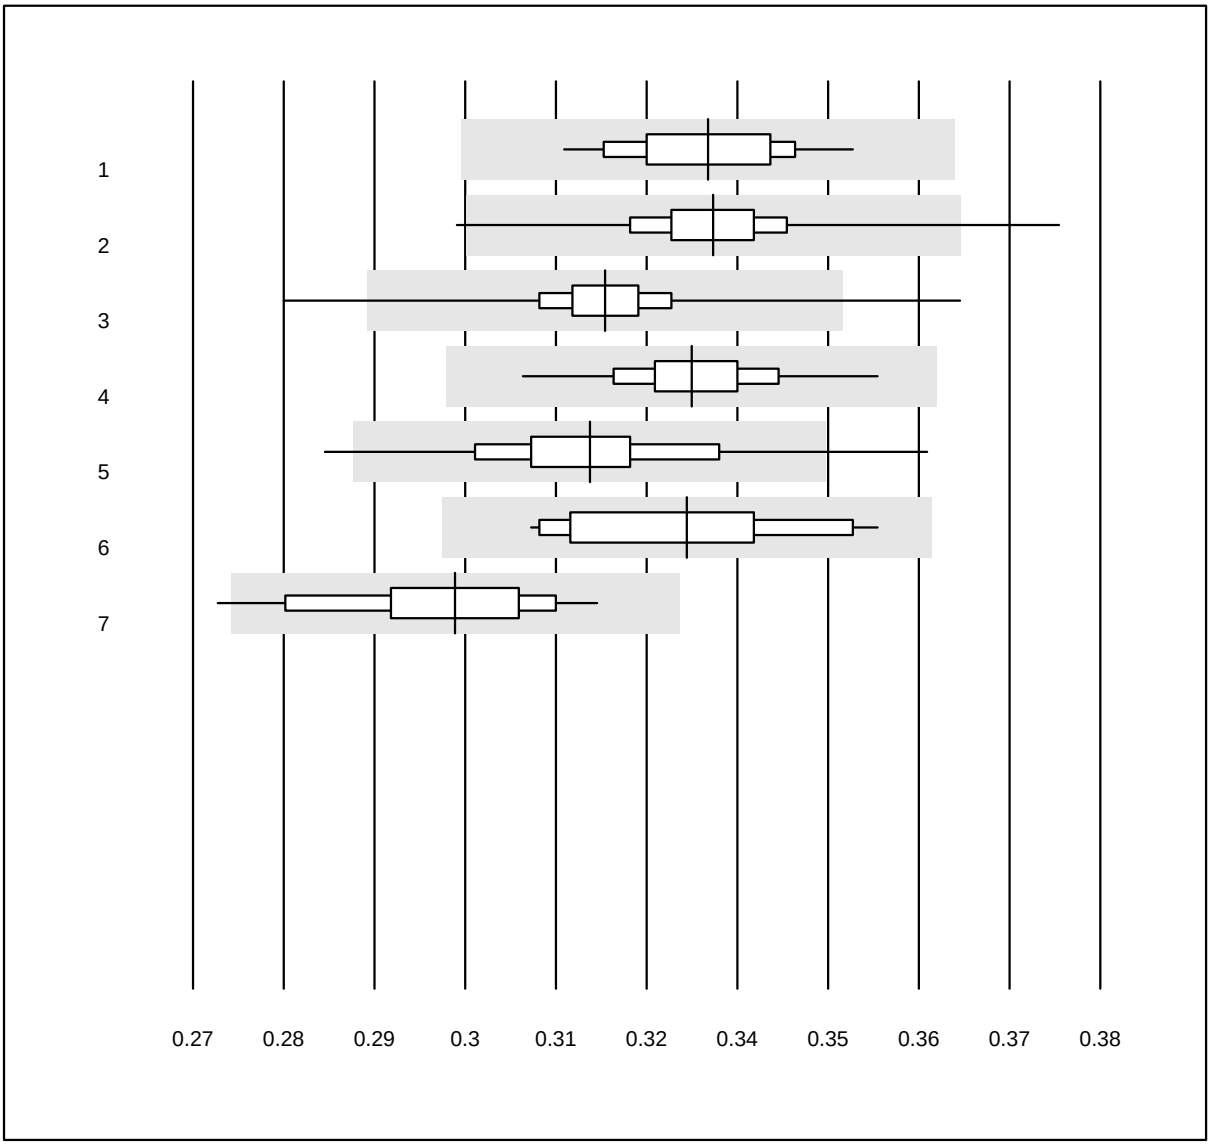


QUALAB Toleranz: 9% Hématocrite (l/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Sysmex XN	58	100.0	0.0	0.0	0.33	2.7	e
2	Sysmex XQ-320	294	98.3	0.7	1.0	0.33	2.4	e
3	Sysmex XP-300	479	97.5	0.8	1.7	0.32	2.4	e
4	Sysmex PocH-100i	174	97.1	0.0	2.9	0.33	2.2	e
5	Mythic	176	93.8	3.4	2.8	0.32	3.7	e
6	Swelab	14	100.0	0.0	0.0	0.33	4.0	e
7	Micros 60	34	94.1	2.9	2.9	0.30	3.9	e

6 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Erythrocytes

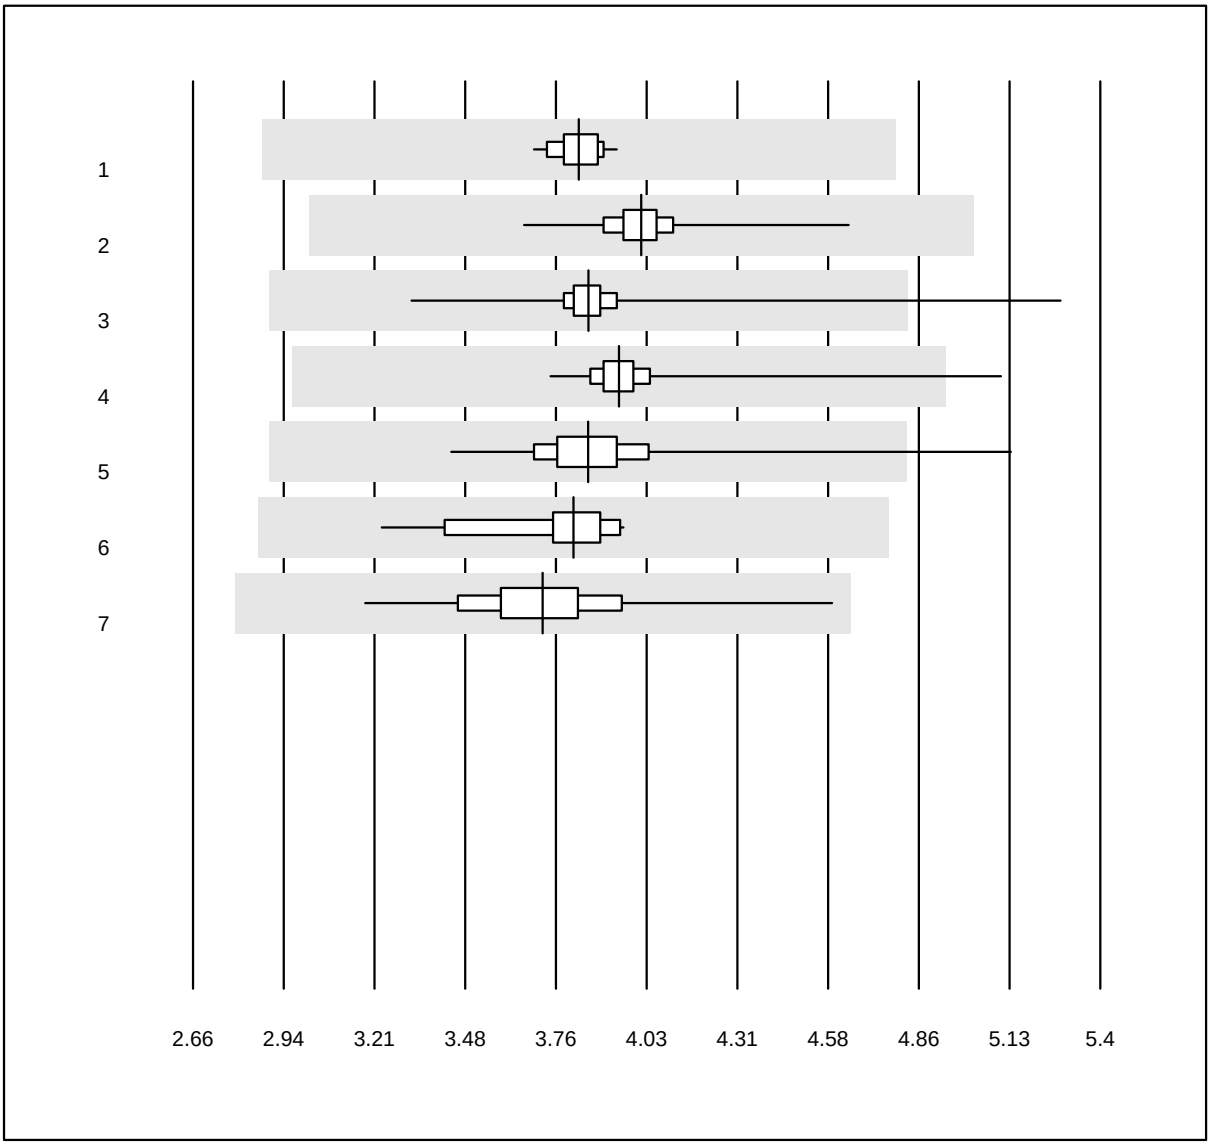


QUALAB Toleranz: 25%

Erythrocytes (T/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Sysmex XN	58	100.0	0.0	0.0	3.83	1.7	e
2	Sysmex XQ-320	295	99.0	0.0	1.0	4.01	2.5	e
3	Sysmex XP-300	478	99.4	0.2	0.4	3.85	3.3	e
4	Sysmex PocH-100i	174	98.3	0.6	1.1	3.95	2.9	e
5	Mythic	176	97.7	0.6	1.7	3.85	4.4	e
6	Swelab	14	100.0	0.0	0.0	3.81	4.8	e
7	Micros 60	34	100.0	0.0	0.0	3.72	6.5	e

5 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Leucocytes

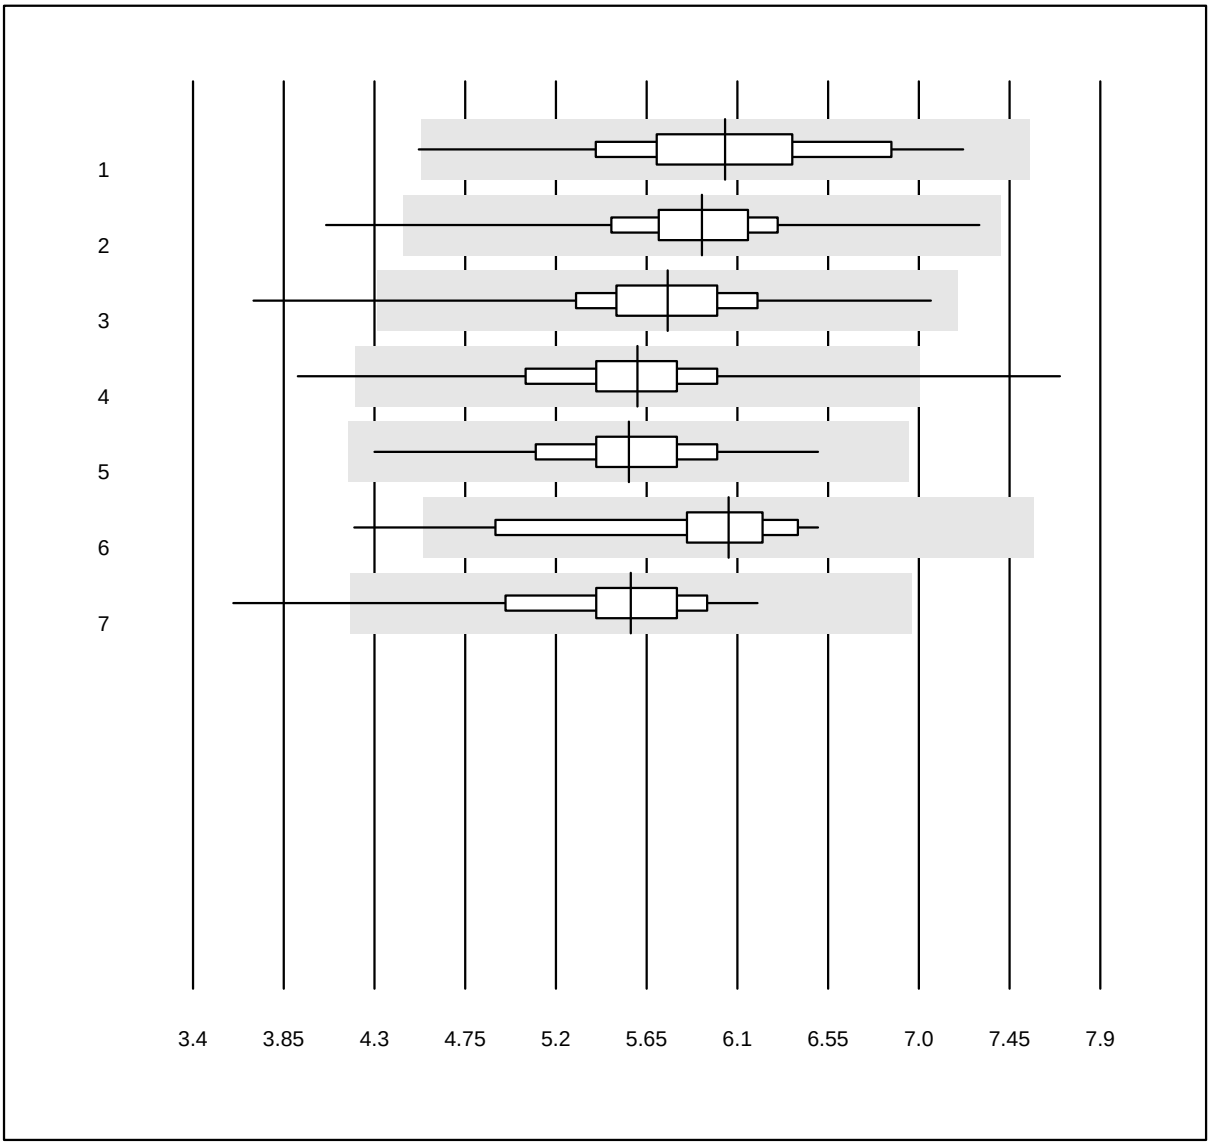


QUALAB Toleranz: 25%

Leucocytes (G/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Sysmex XN	58	98.3	1.7	0.0	6.04	8.6	e
2	Sysmex XQ-320	294	99.3	0.7	0.0	5.92	6.7	e
3	Sysmex XP-300	478	97.9	1.3	0.8	5.75	7.0	e
4	Sysmex PocH-100i	174	97.7	2.3	0.0	5.60	8.1	e
5	Mythic	175	100.0	0.0	0.0	5.56	6.9	e
6	Swelab	14	92.9	7.1	0.0	6.06	9.4	e
7	Micros 60	34	97.1	2.9	0.0	5.57	8.6	e

7 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Thrombocytes

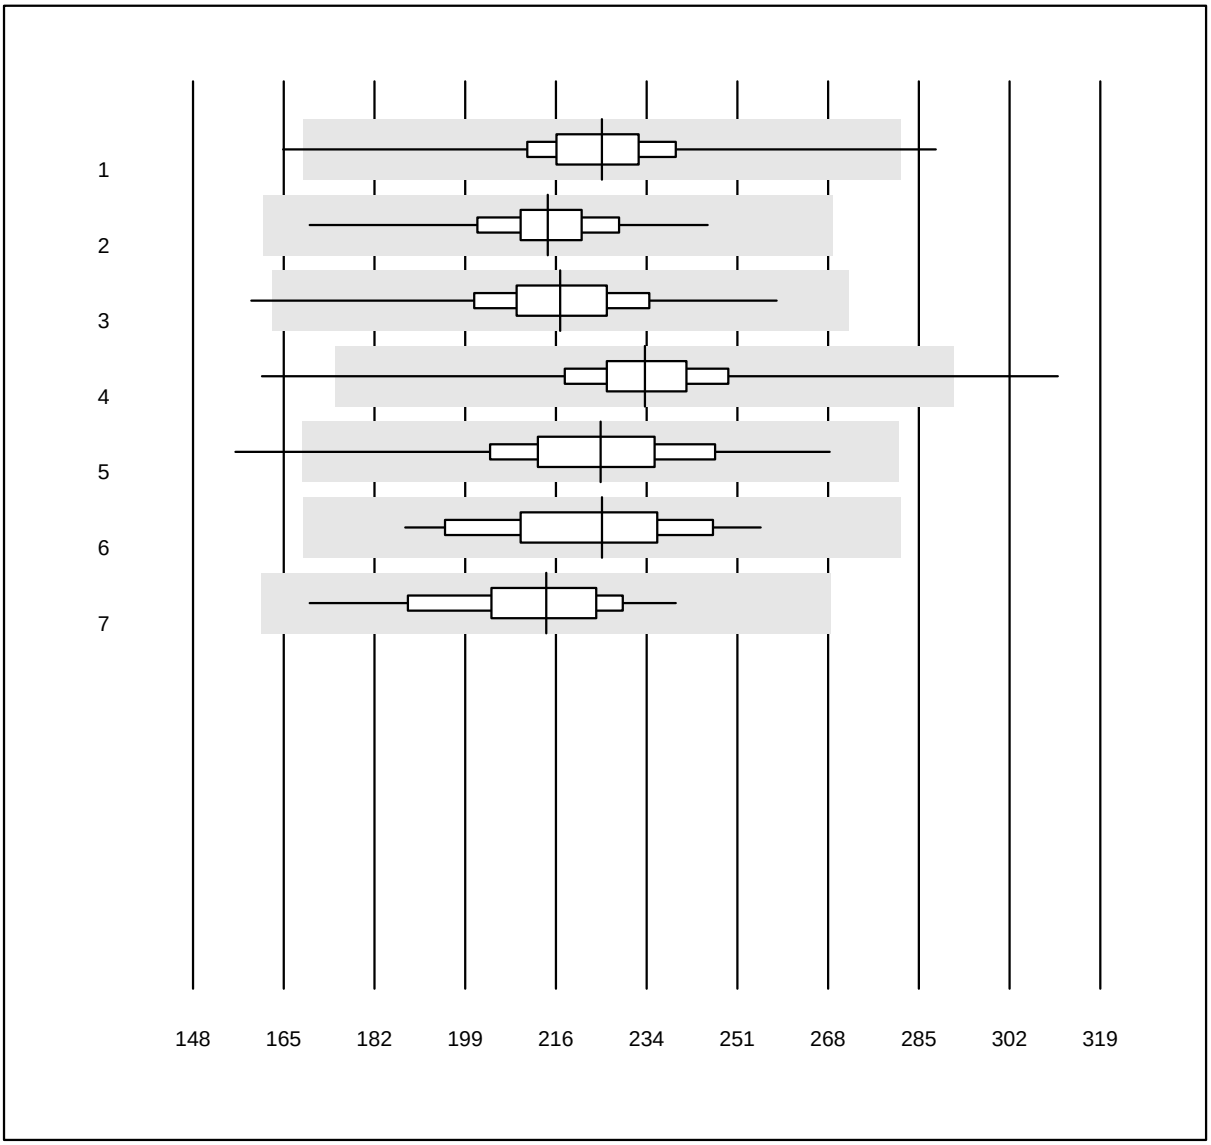


QUALAB Toleranz: 25%

Thrombocytes (G/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Sysmex PocH-100i	174	98.3	1.1	0.6	225.1	6.0	e
2	Sysmex XN	58	100.0	0.0	0.0	214.9	5.7	e
3	Sysmex XQ-320	295	99.0	0.3	0.7	217.2	6.6	e
4	Sysmex XP-300	477	98.1	0.4	1.5	233.2	5.9	e
5	Mythic	176	98.3	1.1	0.6	224.8	7.5	e
6	Swelab	14	100.0	0.0	0.0	225.1	7.8	e
7	Micros 60	34	94.1	0.0	5.9	214.6	7.2	e

6 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Hémoglobine H2

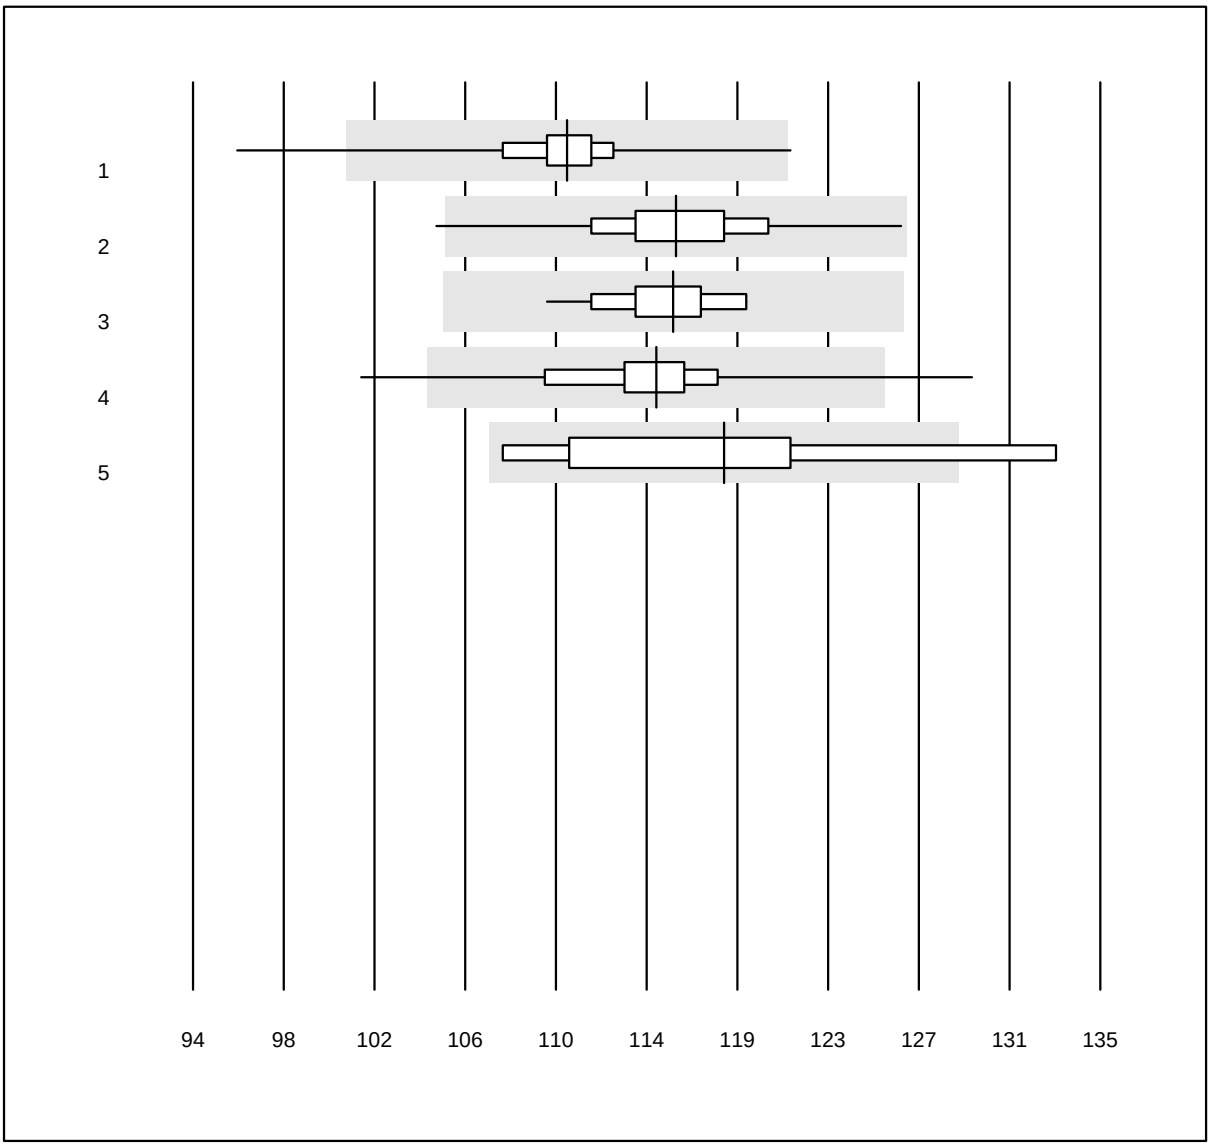


QUALAB Toleranz: 9%

Hémoglobine H2 (g/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Microsemi	964	95.6	1.7	2.7	110.9	2.4	e
2	Zybio Z3	376	98.1	0.5	1.3	115.8	2.8	e
3	Nihon Kohden	30	93.3	0.0	6.7	115.7	1.9	e
4	MEK-1303/5	101	92.1	5.0	3.0	114.9	3.5	e
5	Dymind DP-H10	9	88.9	11.1	0.0	118.0	6.3	e*

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Hématocrite H2

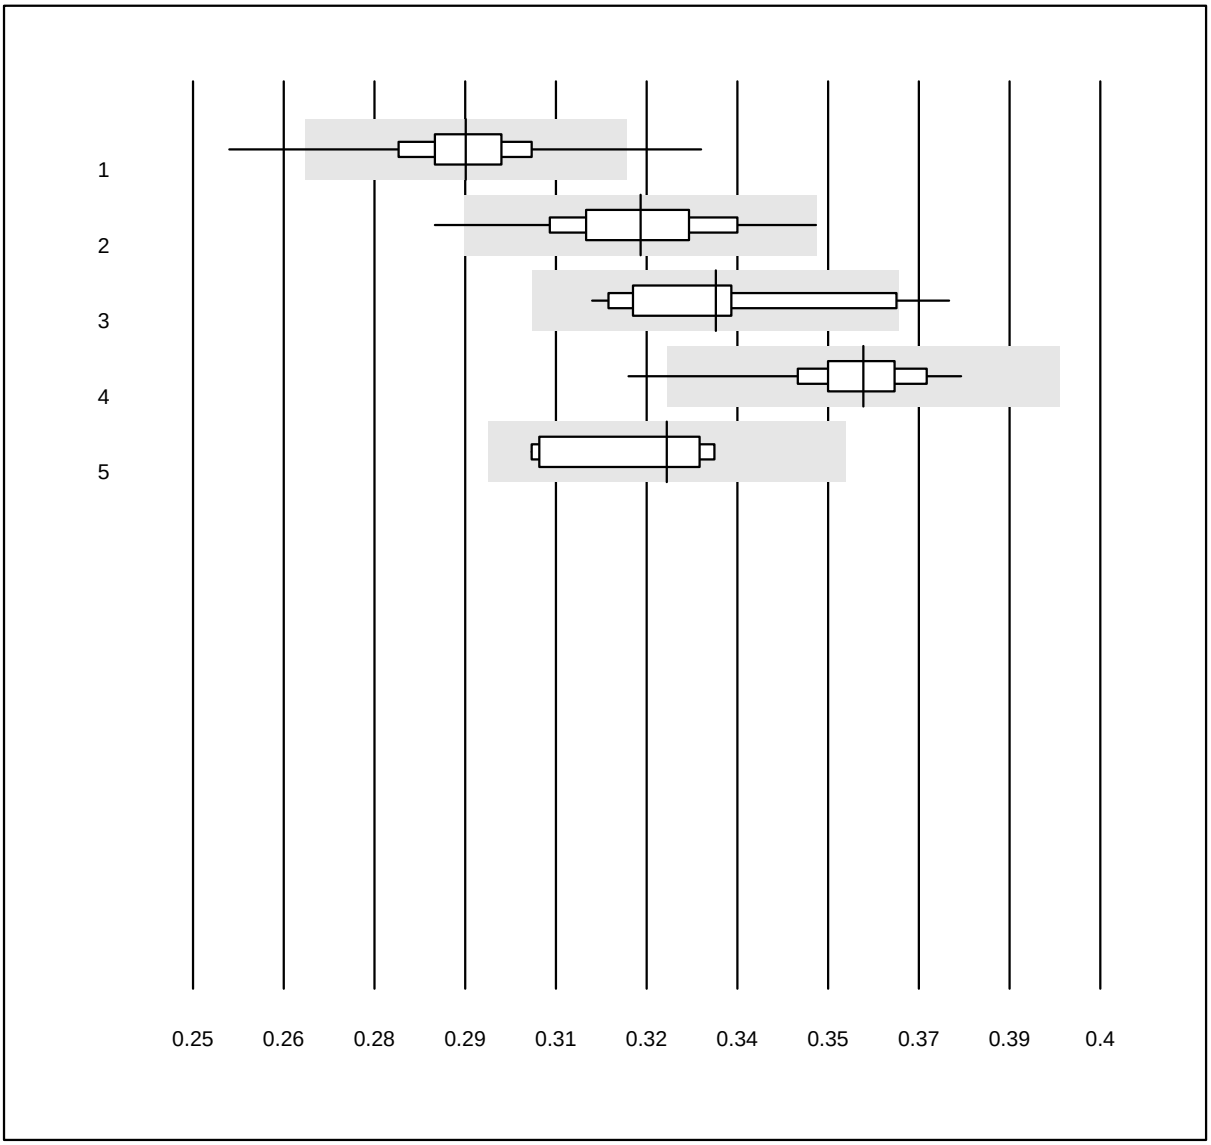


QUALAB Toleranz: 9% Hématocrite H2 (l/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Microsemi	964	94.8	2.3	2.9	0.30	3.3	e
2	Zybio Z3	377	97.3	0.8	1.9	0.32	3.7	e
3	Nihon Kohden	30	86.7	6.7	6.7	0.34	5.2	e
4	MEK-1303/5	100	95.0	1.0	4.0	0.36	2.4	e
5	Dymind DP-H10	9	88.9	0.0	11.1	0.33	4.0	e*

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Erythrocytes H2

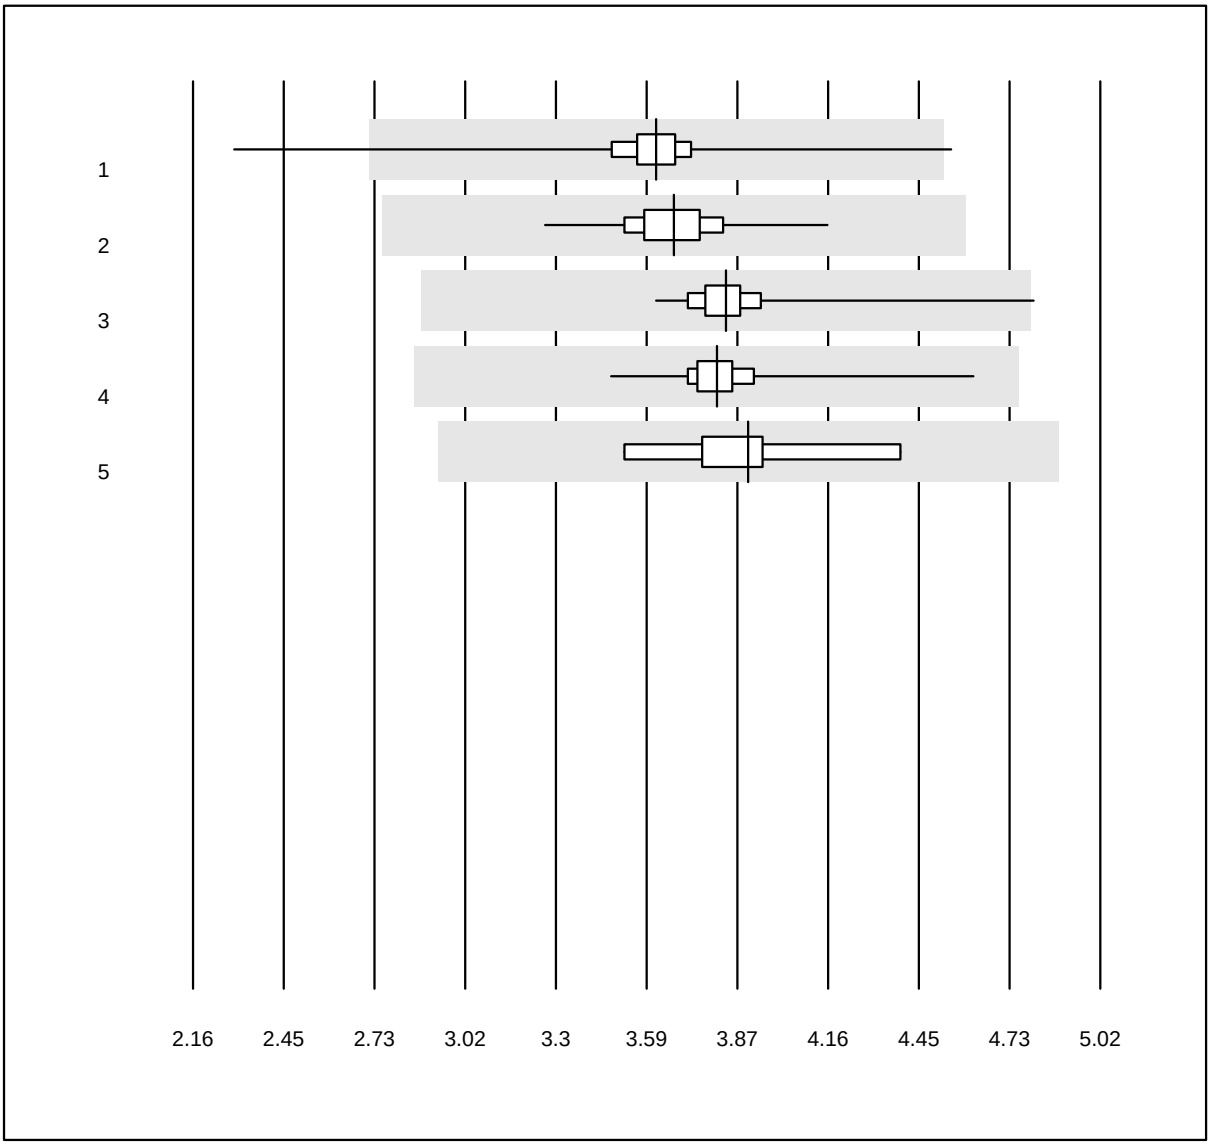


QUALAB Toleranz: 25%

Erythrocytes H2 (T/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Microsemi	964	97.9	1.0	1.0	3.62	4.6	e
2	Zybio Z3	377	97.6	0.0	2.4	3.68	3.4	e
3	Nihon Kohden	30	93.3	3.3	3.3	3.84	5.2	e
4	MEK-1303/5	100	100.0	0.0	0.0	3.81	4.4	e
5	Dymind DP-H10	9	100.0	0.0	0.0	3.91	6.0	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Leucocytes H2

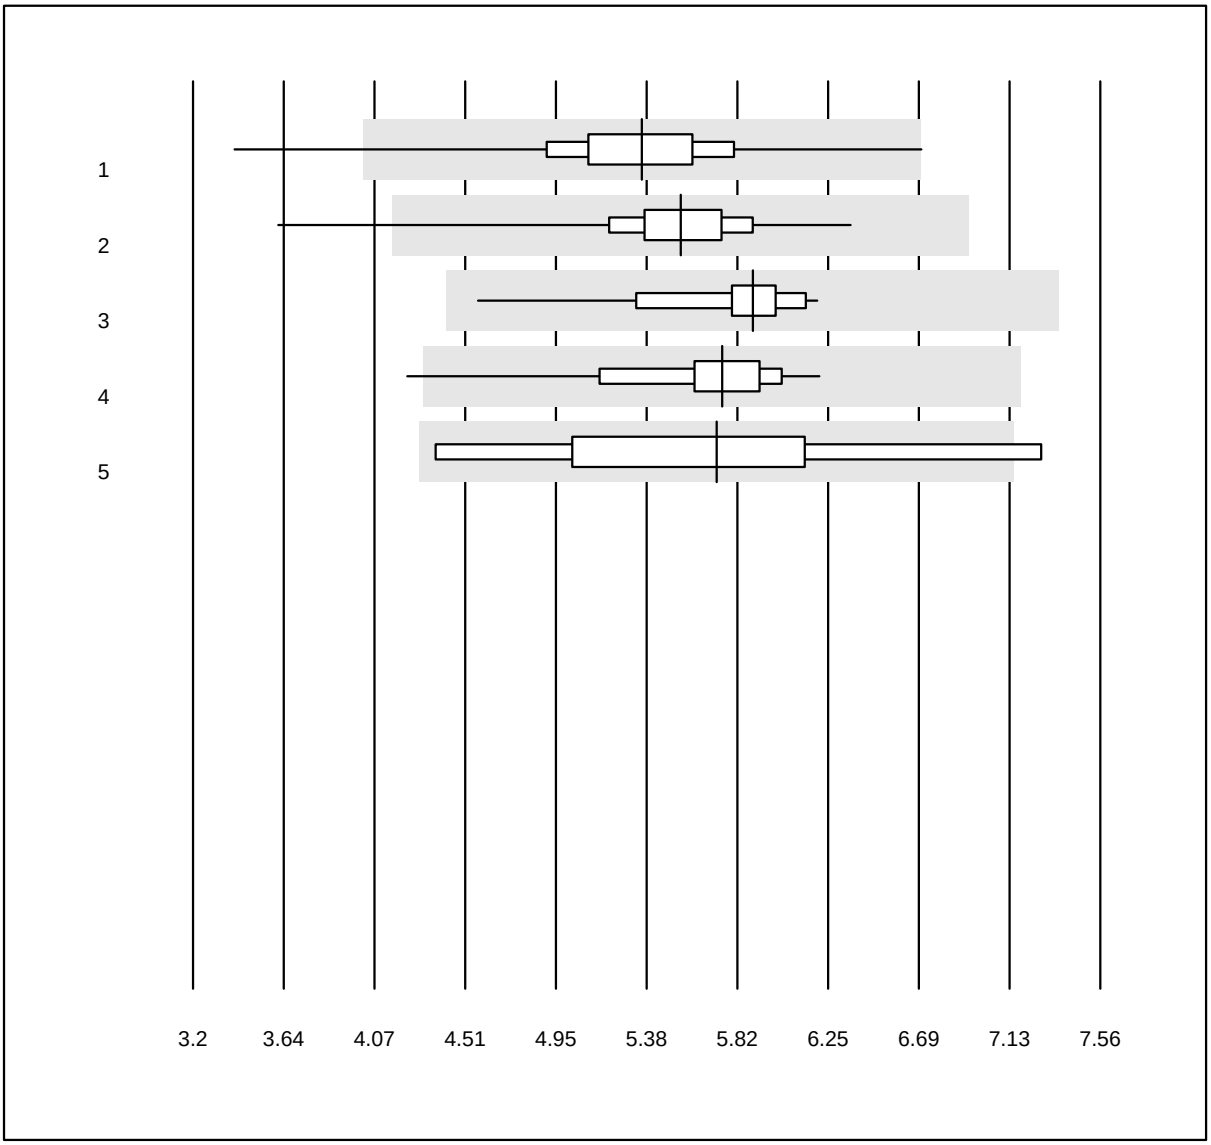


QUALAB Toleranz: 25%

Leucocytes H2 (G/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Microsemi	964	99.0	0.8	0.2	5.36	6.9	e
2	Zybio Z3	377	97.9	0.5	1.6	5.54	5.8	e
3	Nihon Kohden	30	100.0	0.0	0.0	5.89	6.6	e
4	MEK-1303/5	101	98.0	1.0	1.0	5.74	6.2	e
5	Dymind DP-H10	9	77.8	11.1	11.1	5.72	14.8	e*

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Thrombocytes H2

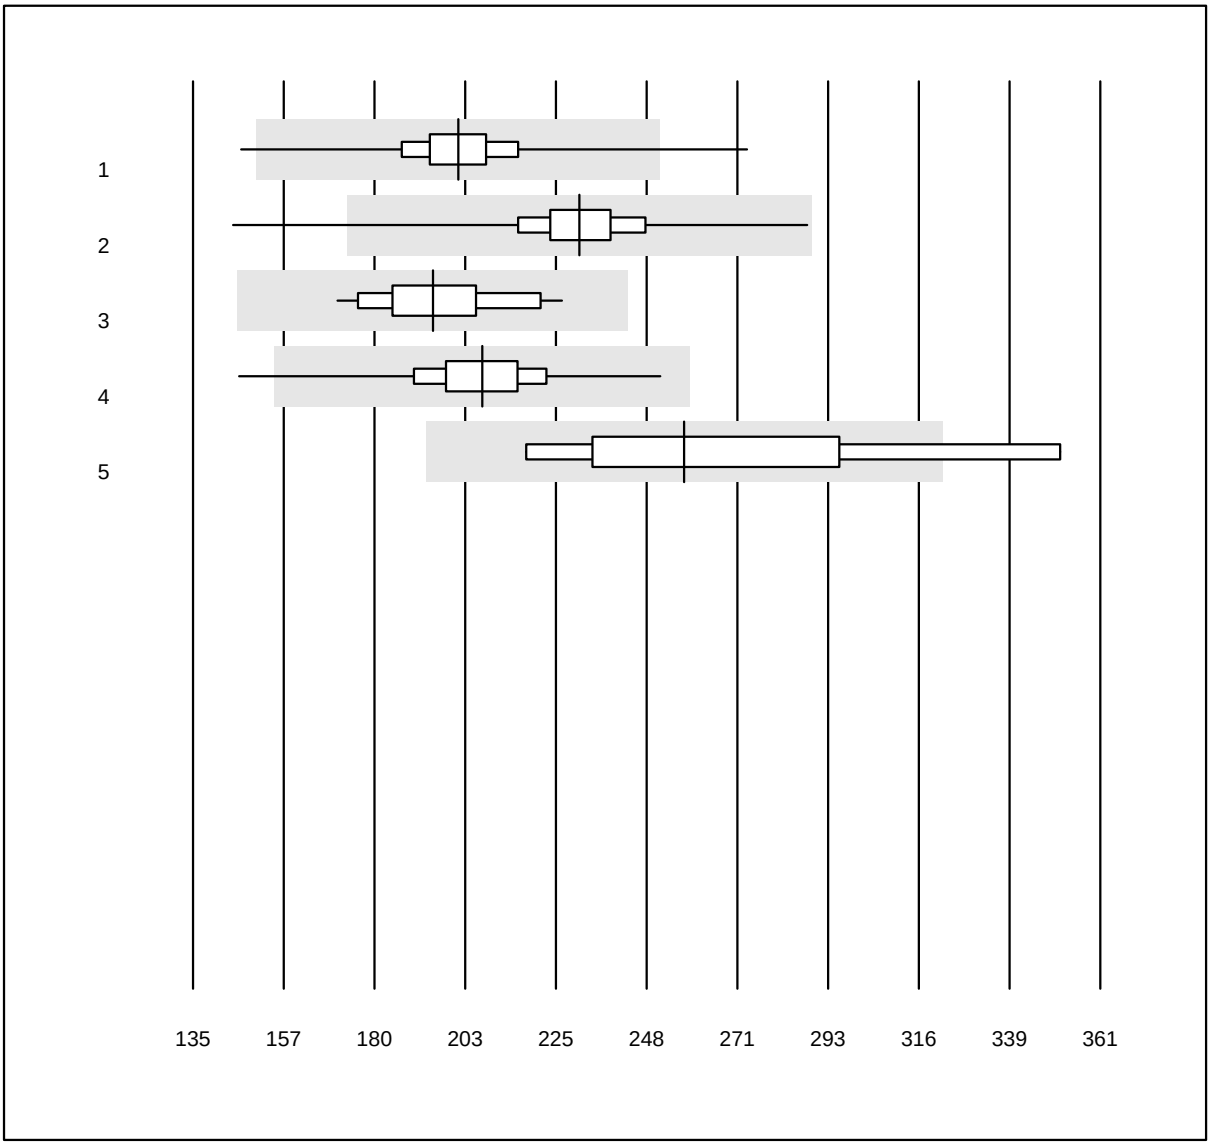


QUALAB Toleranz: 25%

Thrombocytes H2 (G/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Microsemi	964	98.8	0.6	0.6	201.1	6.5	e
2	Zybio Z3	377	98.4	0.3	1.3	231.3	6.1	e
3	Nihon Kohden	30	100.0	0.0	0.0	194.8	8.0	e
4	MEK-1303/5	99	96.0	1.0	3.0	207.1	7.1	e
5	Dymind DP-H10	9	88.9	11.1	0.0	257.3	16.4	e*

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

CRP H2

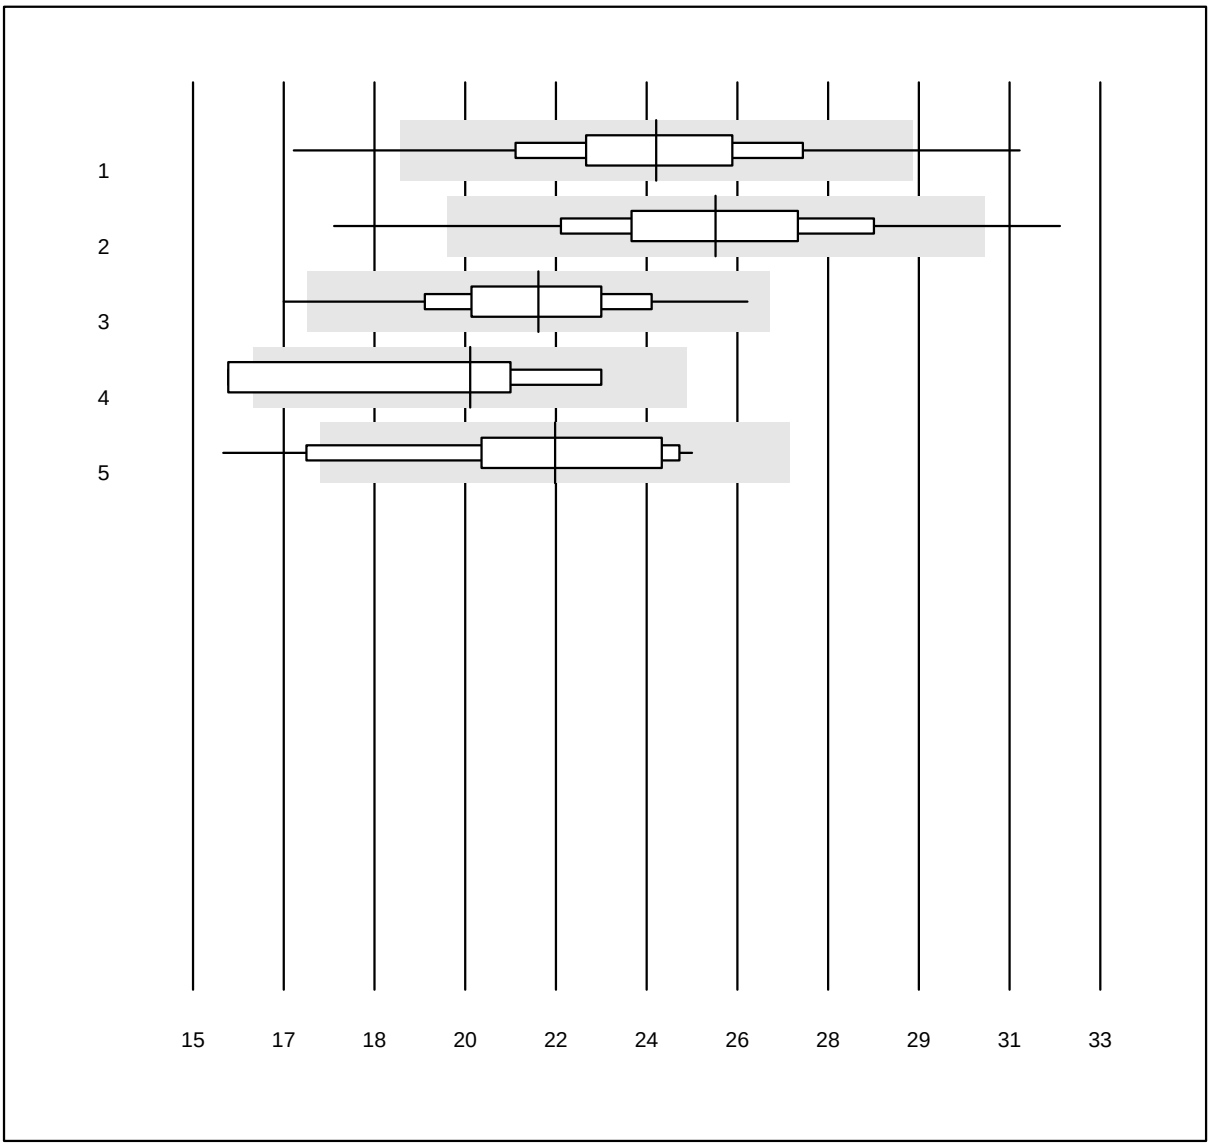


QUALAB Toleranz: 21%

CRP H2 (mg/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Microsemi	951	95.3	2.9	1.8	24.2	9.4	e
2	Zybio Z3	352	95.5	3.4	1.1	25.4	9.6	e
3	MEK-1303/5	89	97.8	1.1	1.1	21.9	8.2	e
4	Dymind DP-H10	8	62.5	25.0	12.5	20.5	14.2	e*
5	Celltac chemi	14	92.9	7.1	0.0	22.2	12.0	e*

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Parasites dans le sang

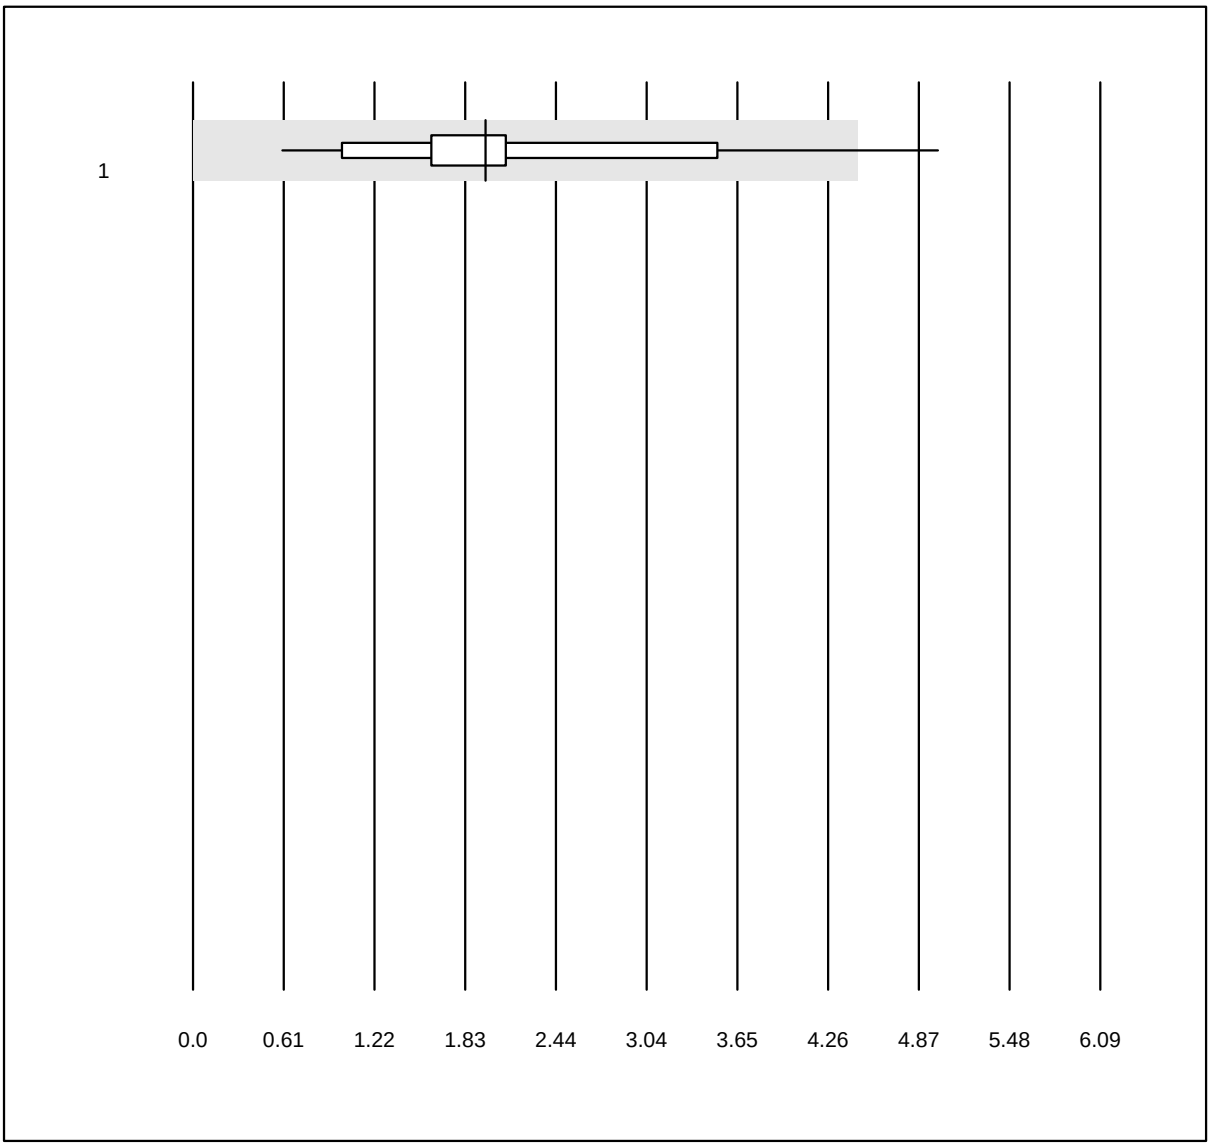


QUALAB Toleranz: 100%
(< 5.0: +/- 2.5 %)

Parasites dans le sang (%)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	parasitémie	27	96.3	3.7	0.0	2.0	45.6	e

Hémoglobine BG

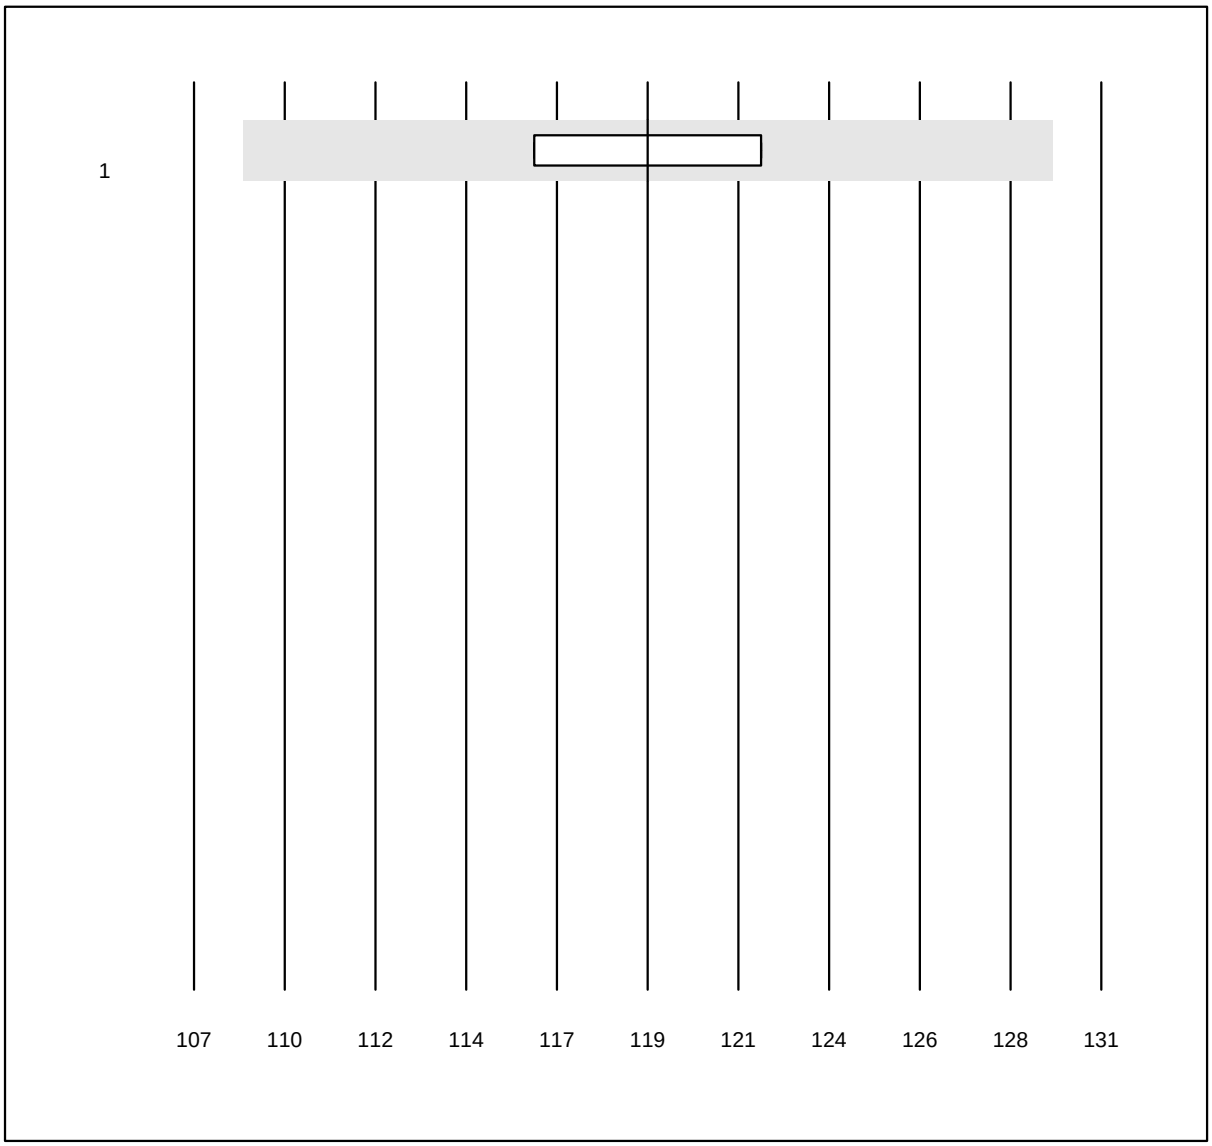


QUALAB Toleranz: 9%

Hémoglobine BG (g/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	iStat	15	100.0	0.0	0.0	119.0	1.9	e


Hématocrite

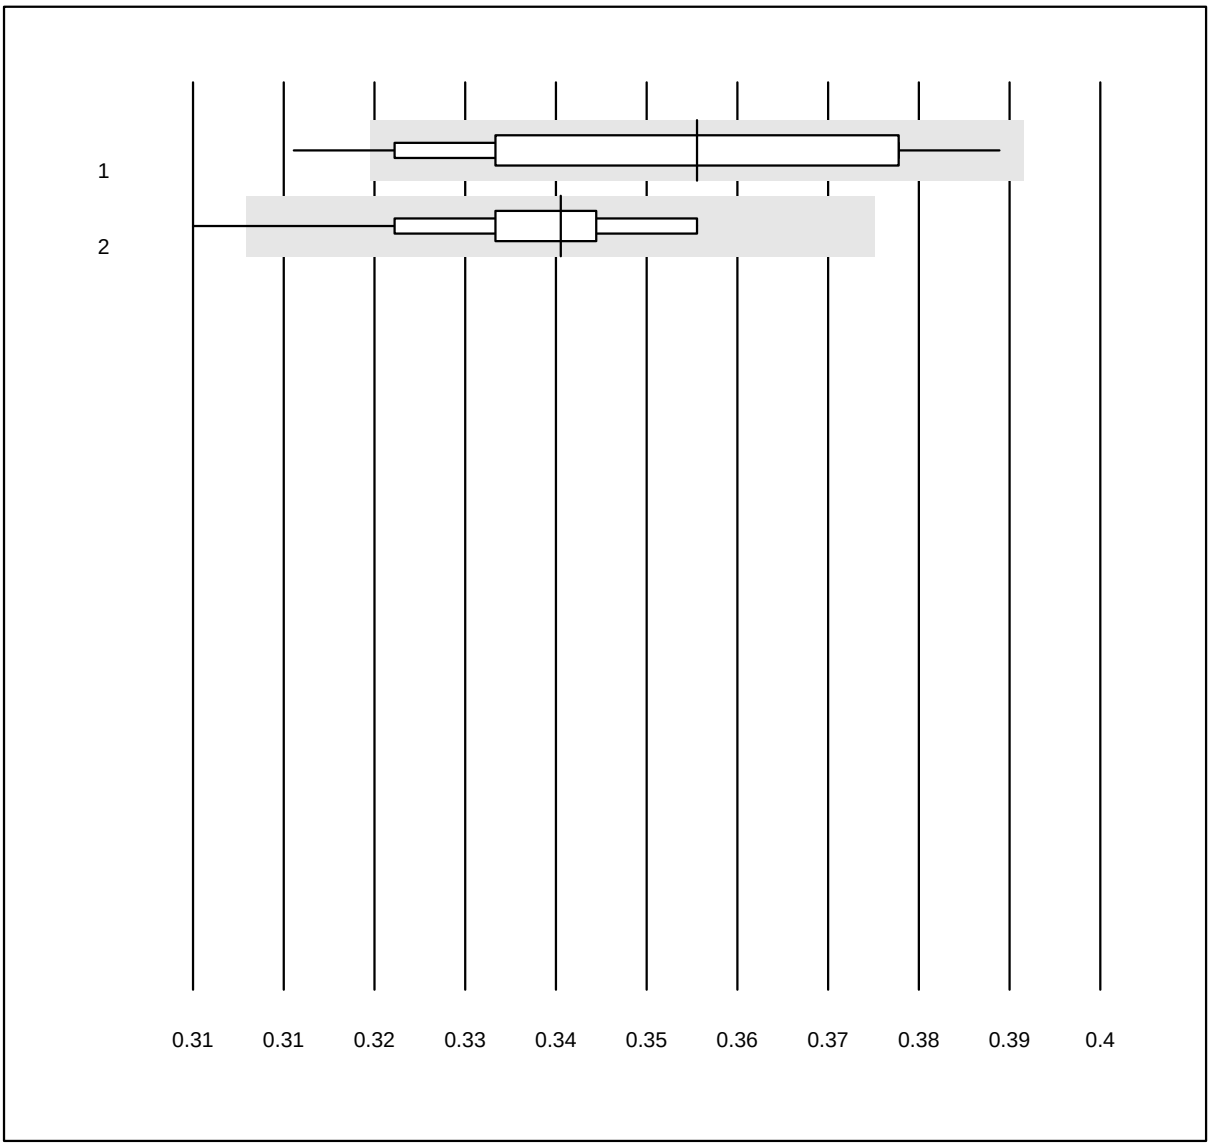

QUALAB Toleranz: 9% Hématocrite (l/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	EPOC	22	95.5	4.5	0.0	0.36	6.3	a*
2	iStat	20	95.0	5.0	0.0	0.35	3.6	e

Hémoglobine

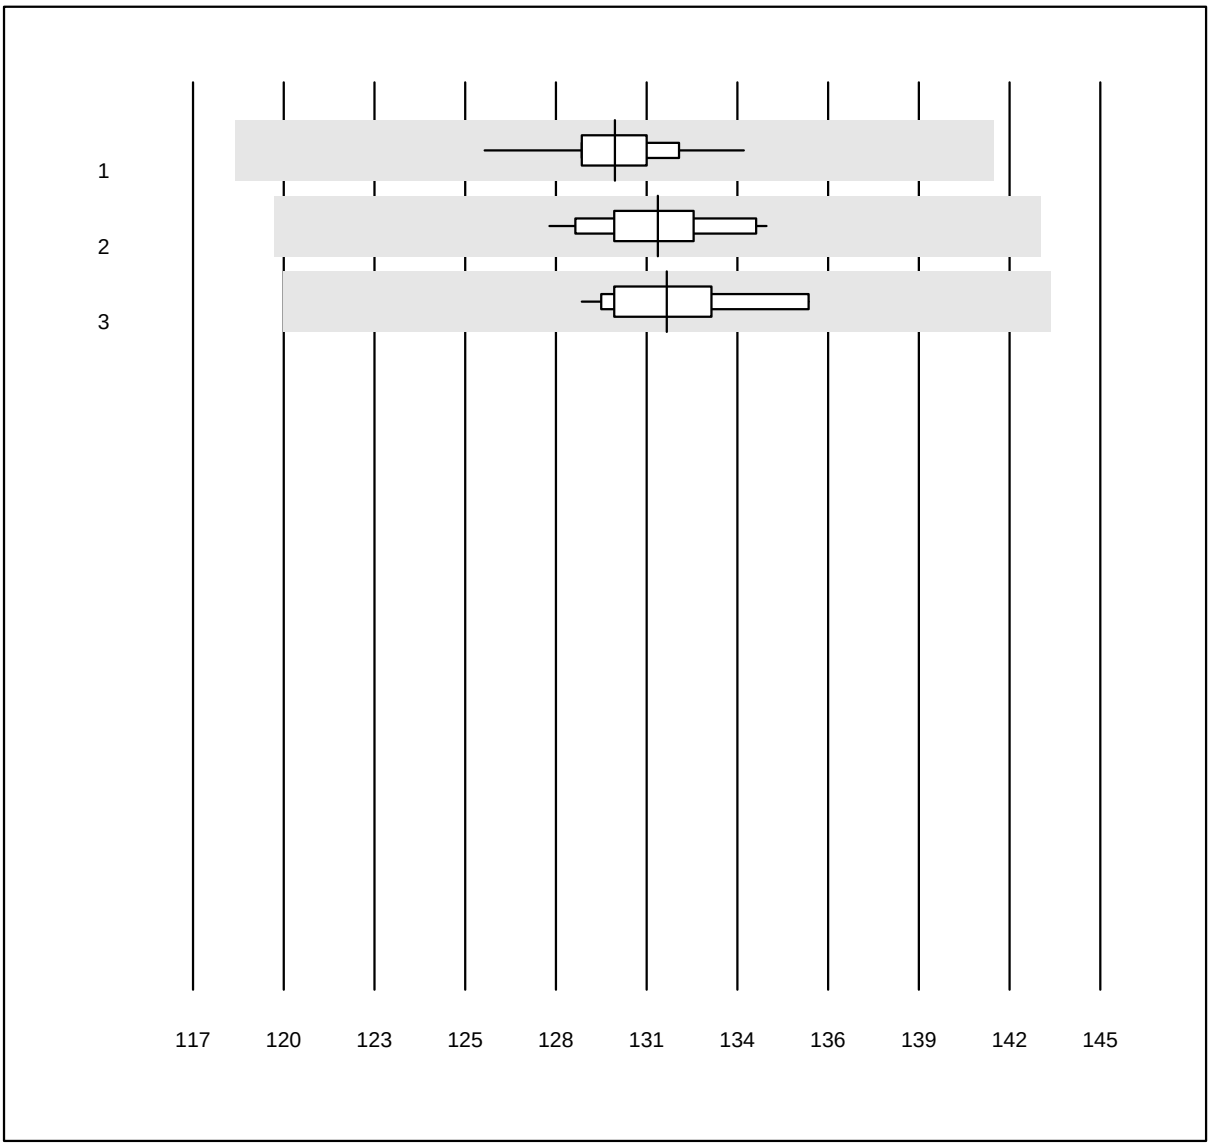


QUALAB Toleranz: 9%

Hémoglobine (g/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Sysmex	142	99.3	0.0	0.7	130.0	0.9	e
2	Beckman	17	100.0	0.0	0.0	131.3	1.4	e
3	Yumizen/Pentra	15	100.0	0.0	0.0	131.6	1.6	e


Hématocrite

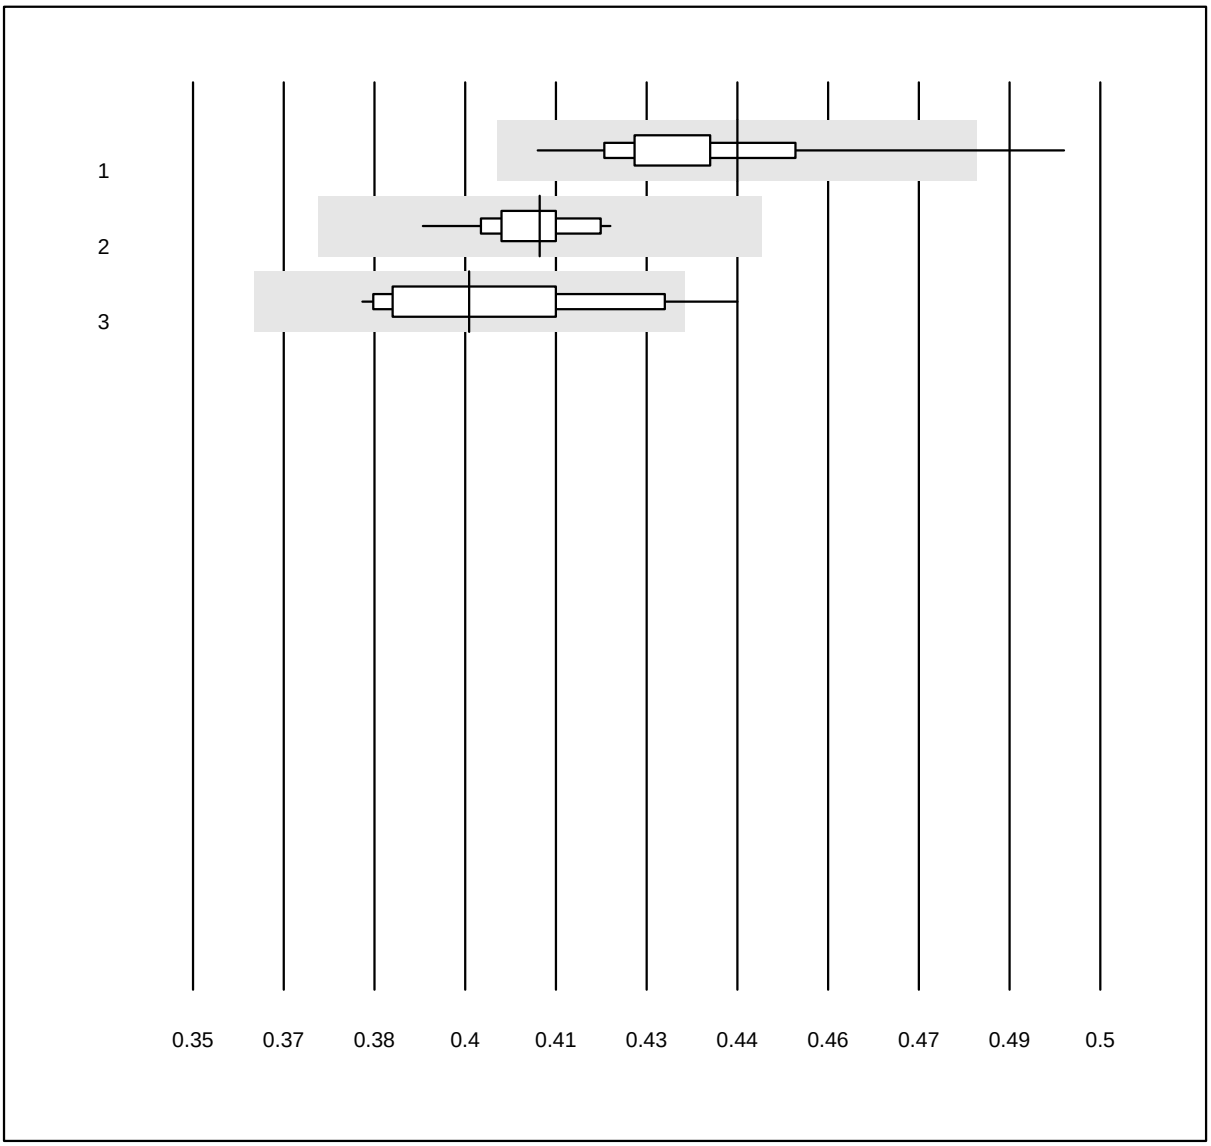

QUALAB Toleranz: 9% Hématocrite (l/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Sysmex	142	97.9	1.4	0.7	0.44	3.3	a
2	Beckman	17	100.0	0.0	0.0	0.41	1.8	e
3	Yumizen/Pentra	15	93.3	6.7	0.0	0.40	4.3	e*

Erythrocytes

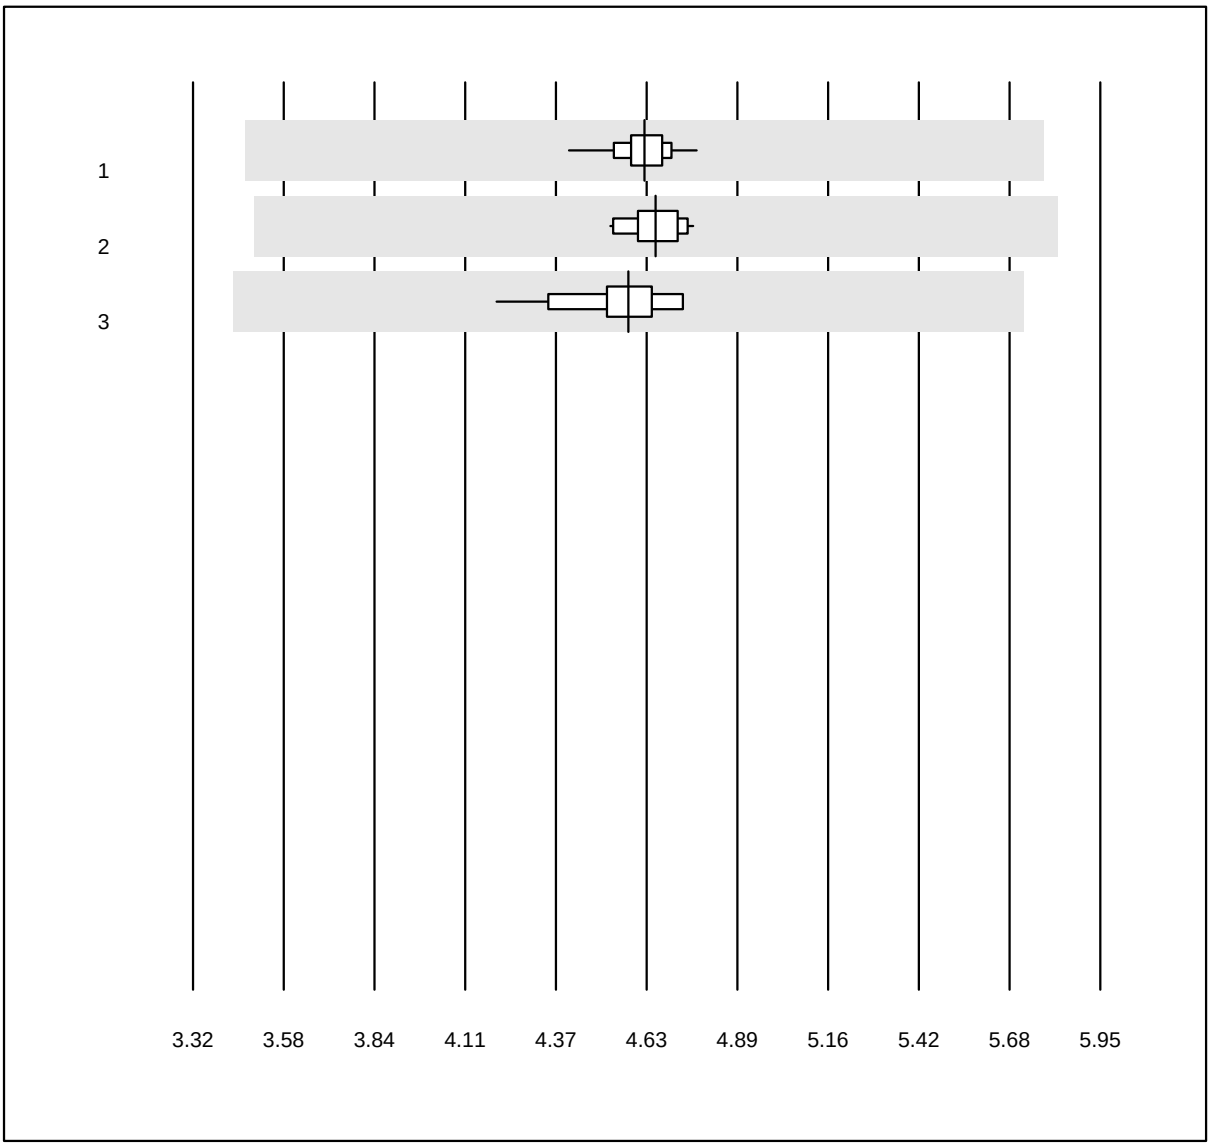


QUALAB Toleranz: 25%

Erythrocytes (T/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Sysmex	142	100.0	0.0	0.0	4.63	1.4	e
2	Beckman	17	100.0	0.0	0.0	4.66	1.6	e
3	Yumizen/Pentra	15	100.0	0.0	0.0	4.58	3.0	e

Leucocytes

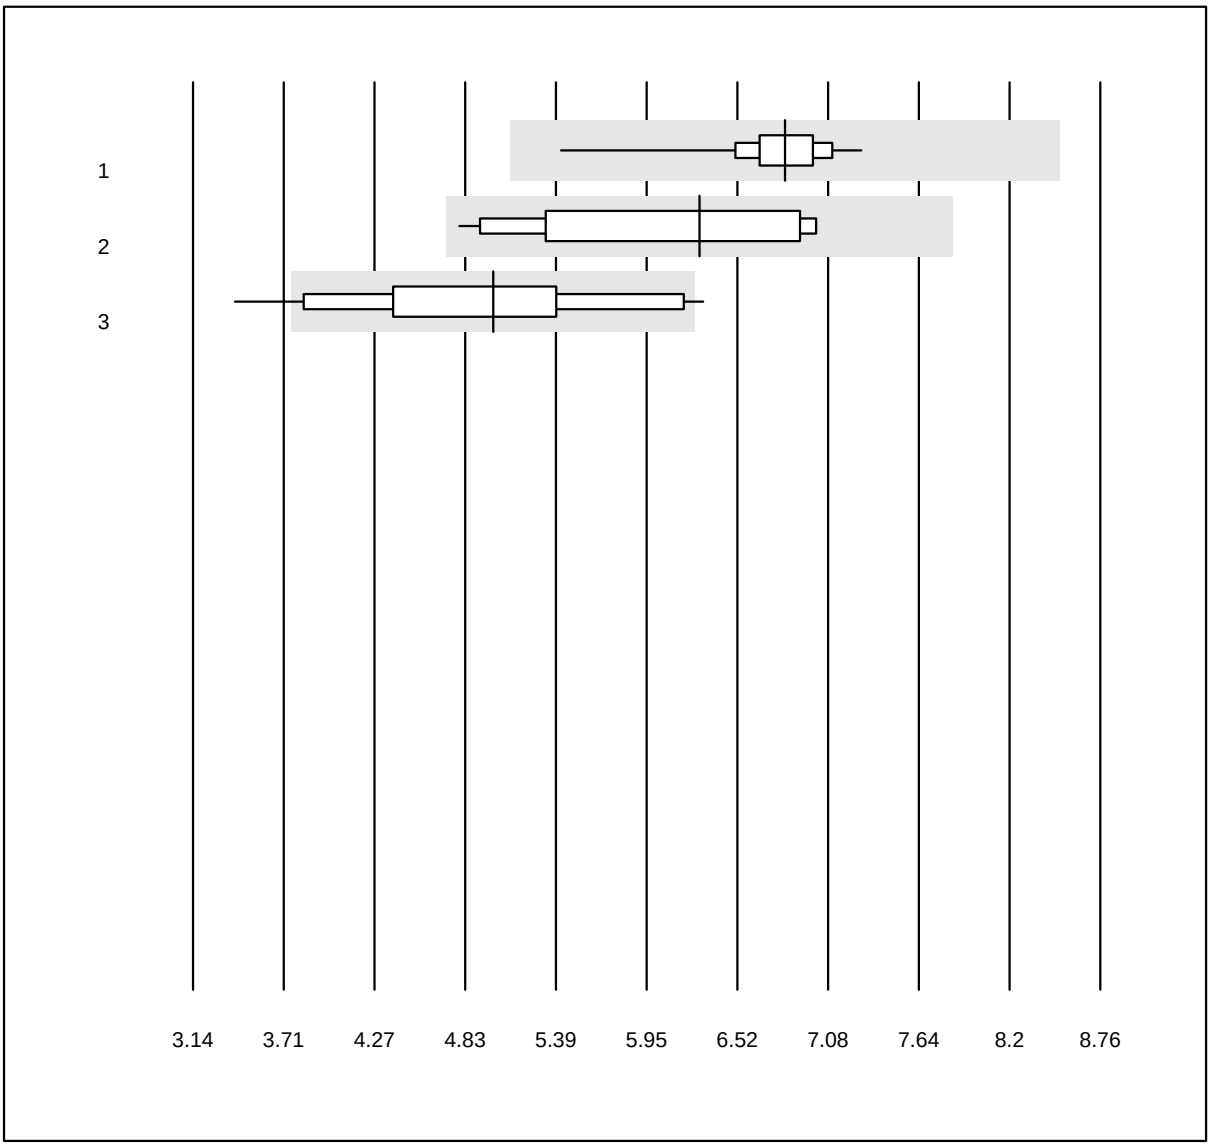


QUALAB Toleranz: 25%

Leucocytes (G/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Sysmex	141	100.0	0.0	0.0	6.81	4.0	e
2	Beckman	17	100.0	0.0	0.0	6.28	12.5	e*
3	Yumizen/Pentra	16	81.2	12.5	6.2	5.00	15.5	a*

Thrombocytes

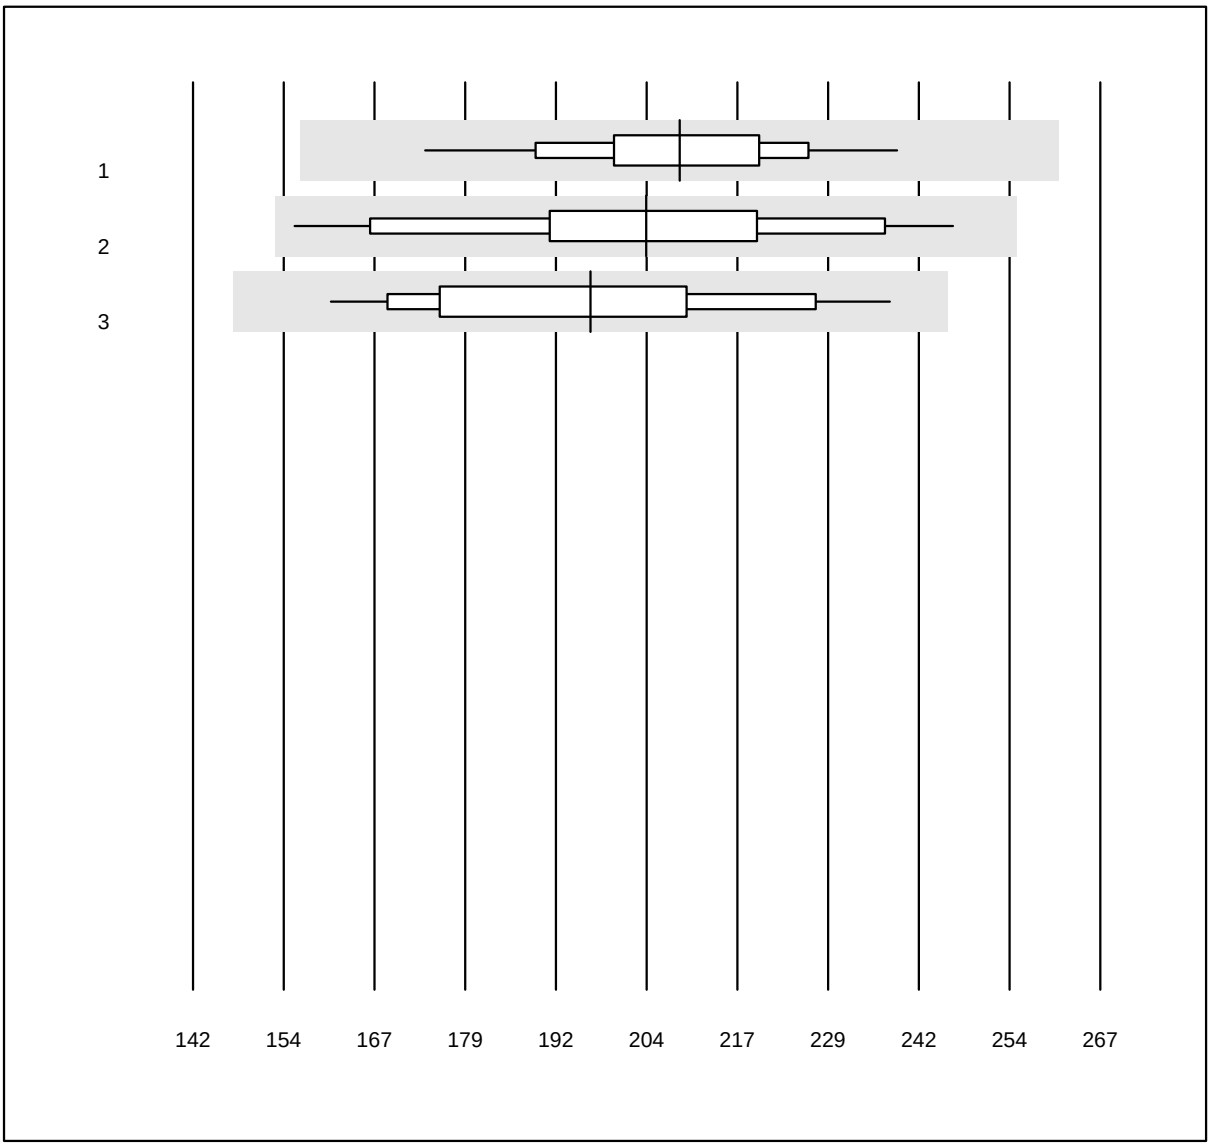


QUALAB Toleranz: 25%

Thrombocytes (G/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Sysmex	141	100.0	0.0	0.0	209.1	6.8	e
2	Beckman	17	100.0	0.0	0.0	204.4	11.5	e
3	Yumizen/Pentra	15	100.0	0.0	0.0	196.8	10.5	e

Neutrophiles

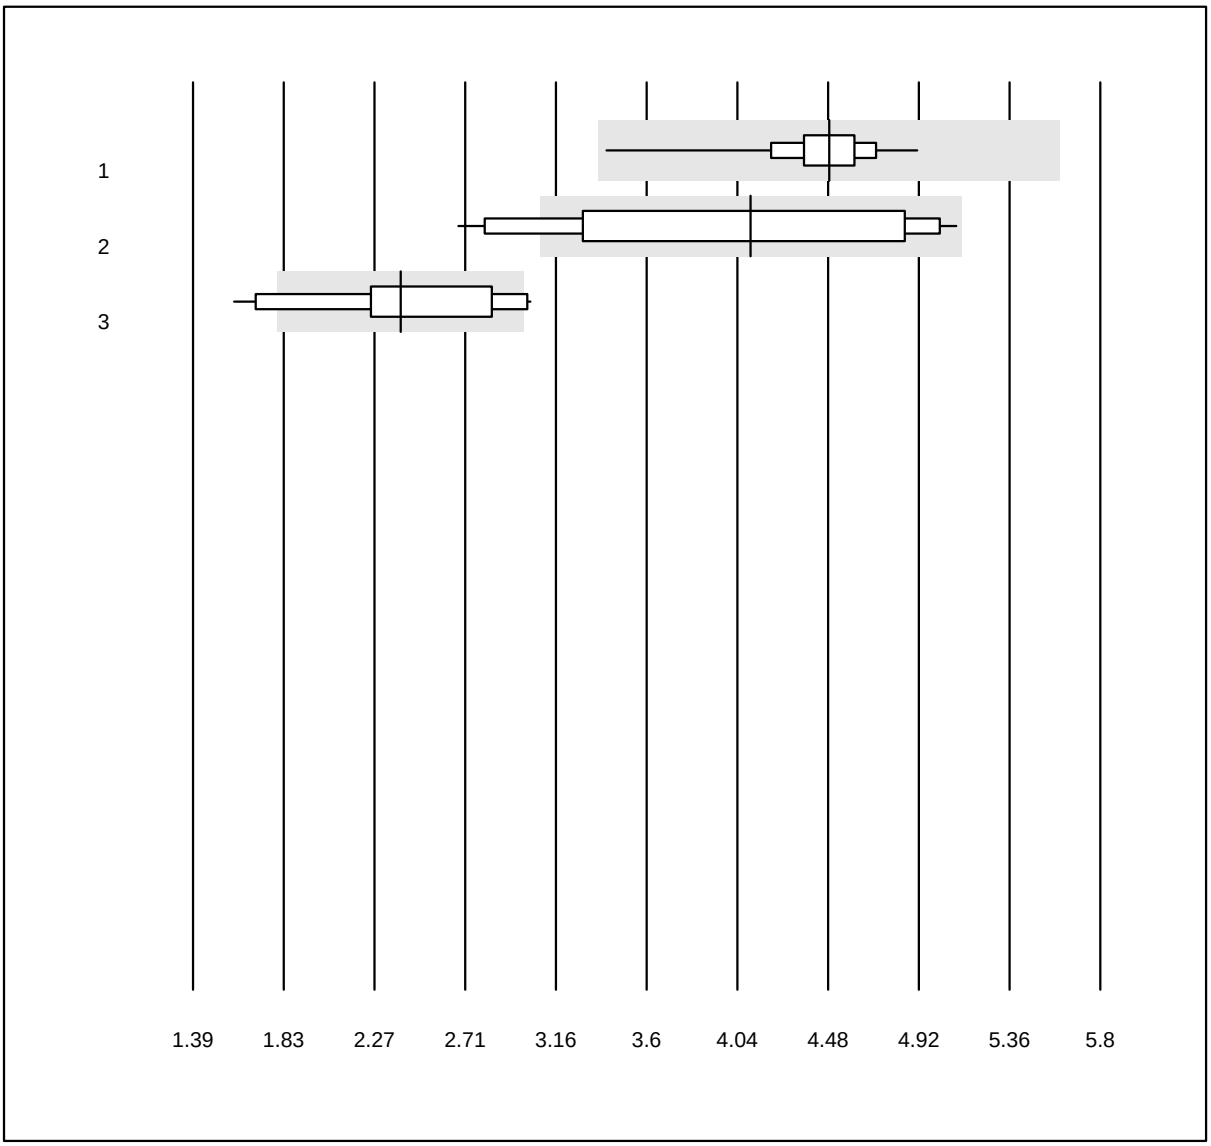


MQ Toleranz: 25%

Neutrophiles (G/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Sysmex	142	100.0	0.0	0.0	4.48	5.5	e
2	Beckman	17	88.2	11.8	0.0	4.10	19.6	a*
3	Yumizen/Pentra	15	73.3	20.0	6.7	2.40	17.5	e*

Lymphocytes

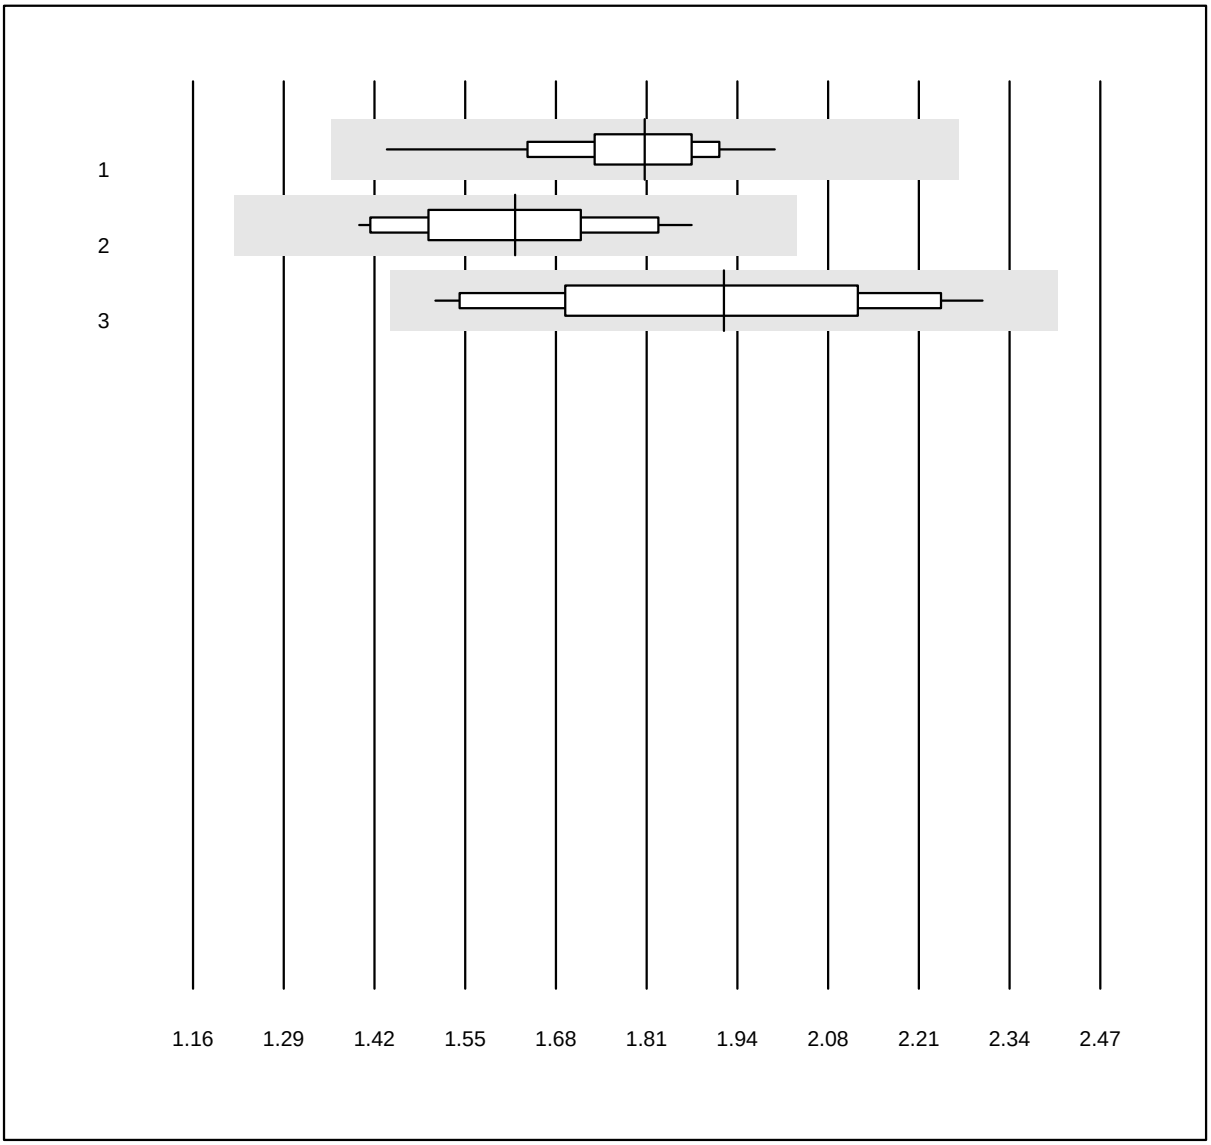


MQ Toleranz: 25%

Lymphocytes (G/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Sysmex	142	100.0	0.0	0.0	1.81	6.0	e
2	Beckman	17	100.0	0.0	0.0	1.63	8.8	e
3	Yumizen/Pentra	15	93.3	0.0	6.7	1.93	12.9	e*

Monocytes

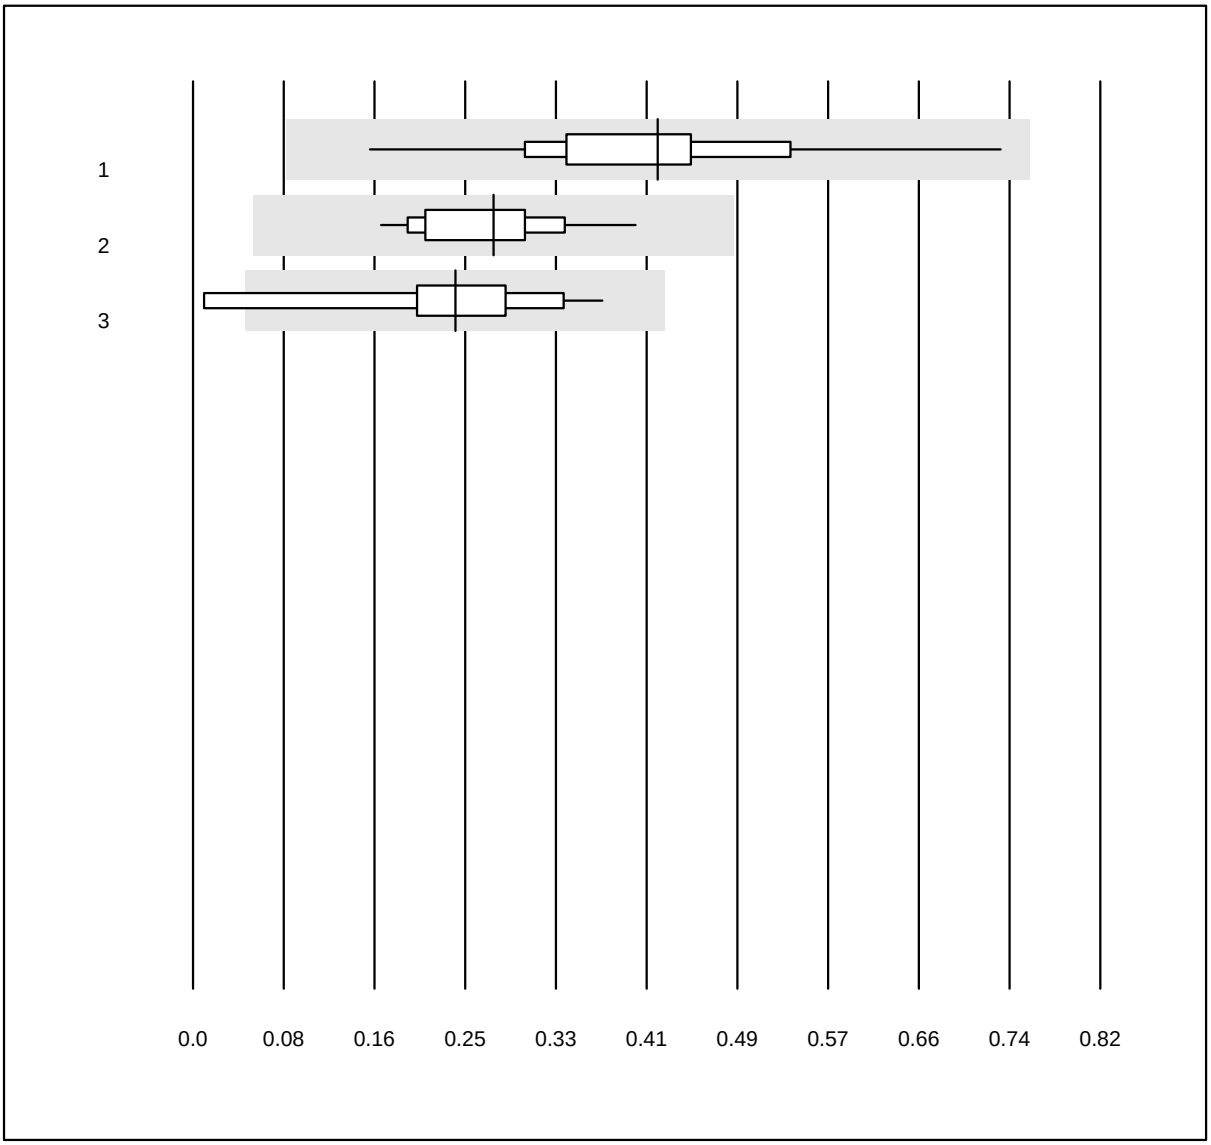


MQ Toleranz: 80%

Monocytes (G/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Sysmex	142	100.0	0.0	0.0	0.42	24.4	a
2	Beckman	17	100.0	0.0	0.0	0.27	21.8	e
3	Yumizen/Pentra	14	85.7	14.3	0.0	0.24	46.2	e*

Eosinophiles

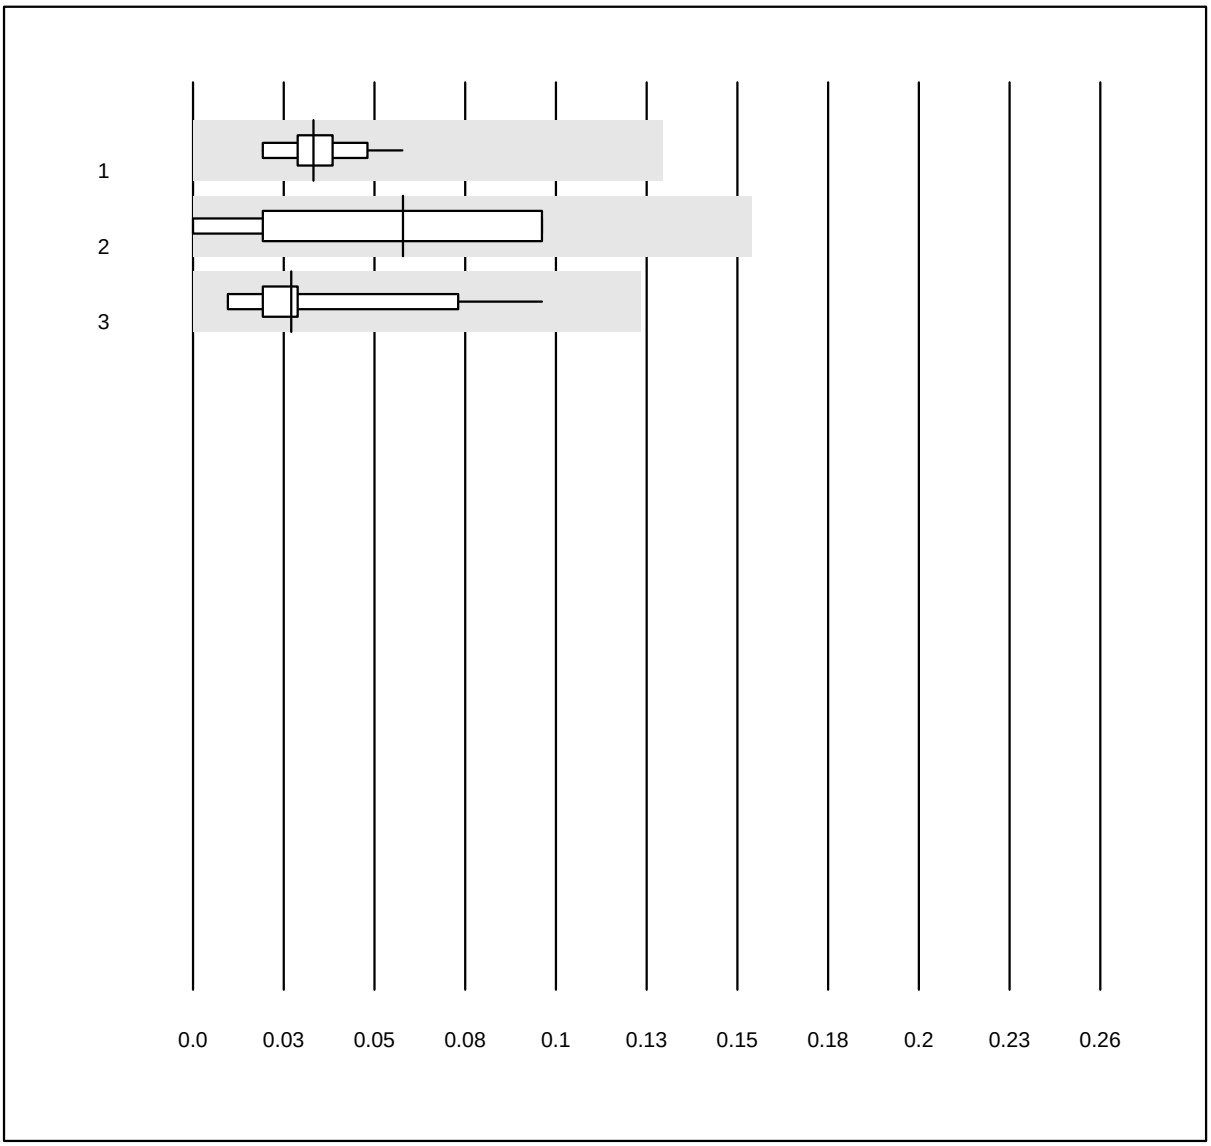


MQ Toleranz: 80%
(< 0.13: +/- 0.1 G/l)

Eosinophiles (G/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Sysmex	139	99.3	0.0	0.7	0.03	31.0	e
2	Beckman	17	100.0	0.0	0.0	0.06	65.8	e
3	Yumizen/Pentra	15	100.0	0.0	0.0	0.03	72.0	e

Basophiles

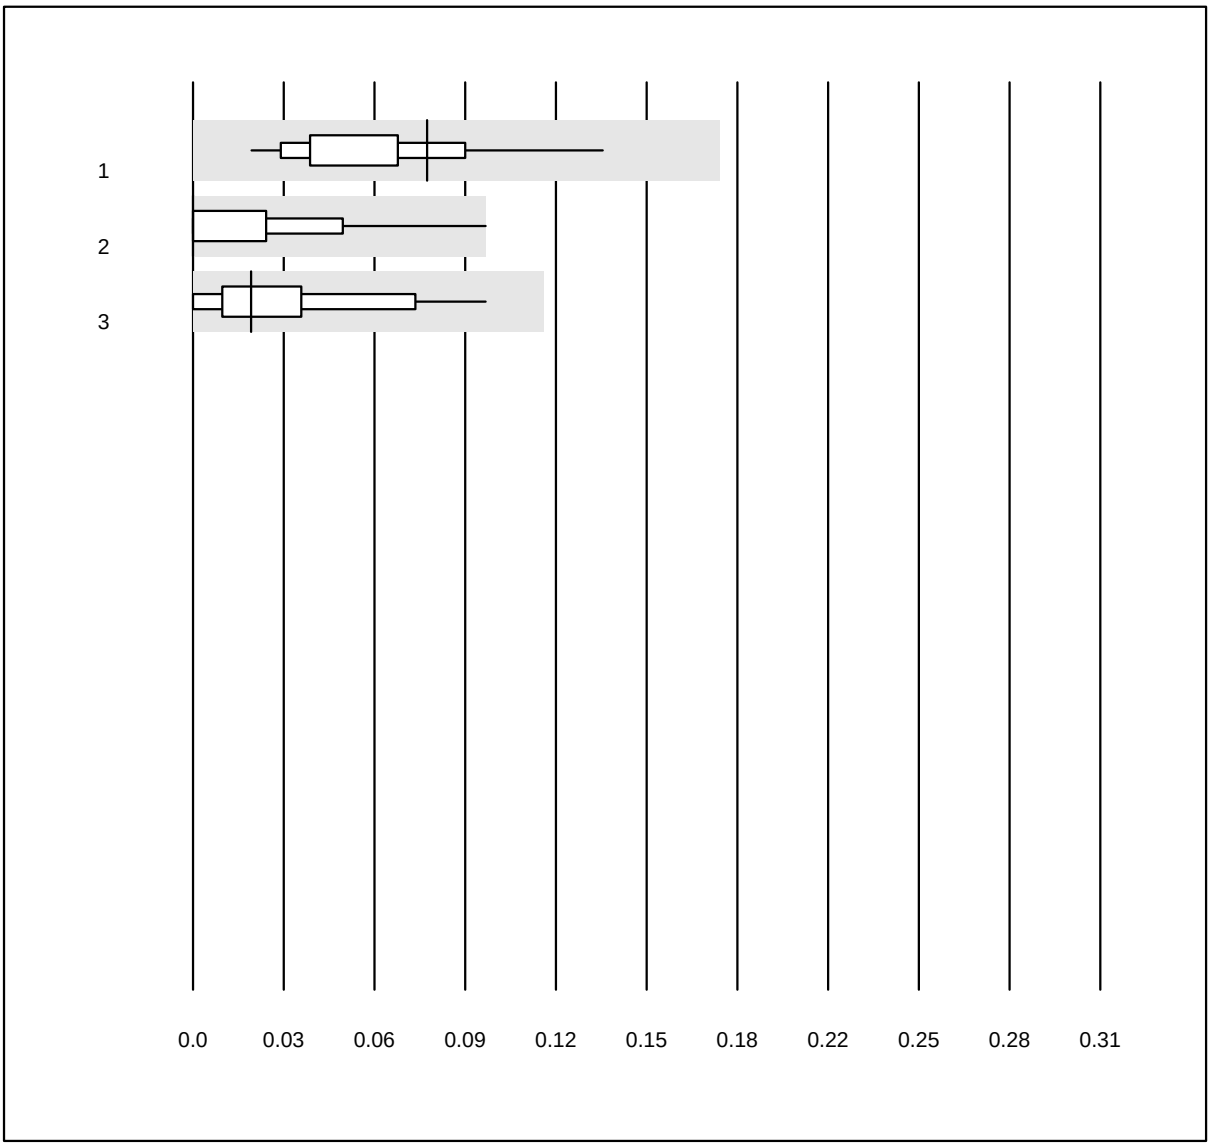


MQ Toleranz: 80%
(< 0.13: +/- 0.1 G/l)

Basophiles (G/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Sysmex	139	97.8	0.0	2.2	0.08	46.0	a
2	Beckman	17	100.0	0.0	0.0	0.00	172.3	e
3	Yumizen/Pentra	15	100.0	0.0	0.0	0.02	114.9	e

Immature Granulocytes

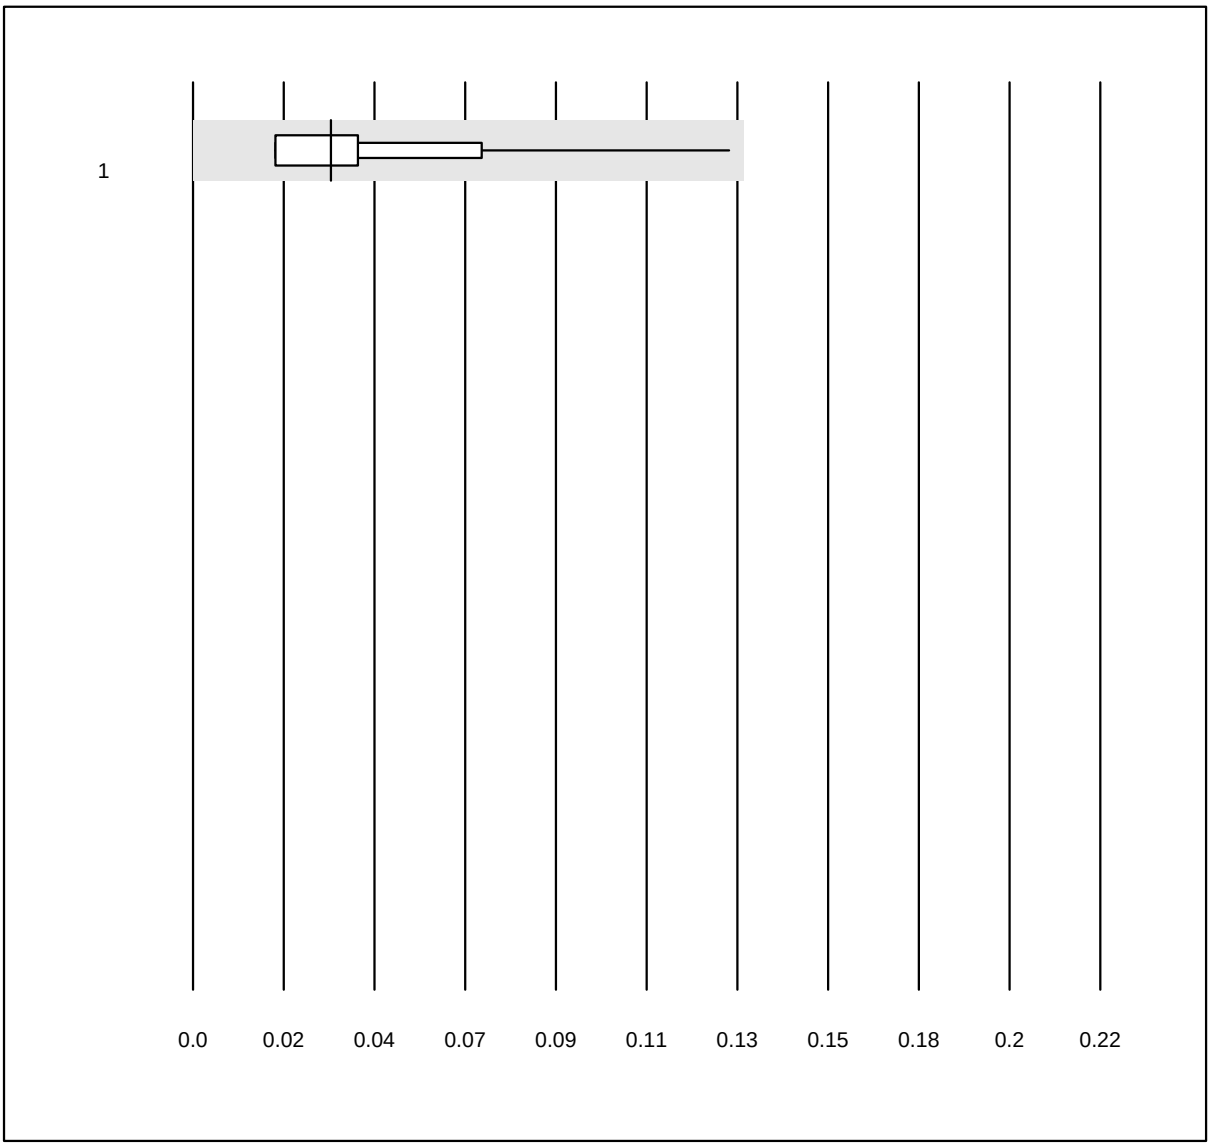


MQ Toleranz: 25%
(< 1.3: +/- 0.1 G/l)

Immature Granulocytes
(G/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Sysmex	128	99.2	0.0	0.8	0.03	57.0	e

MCV

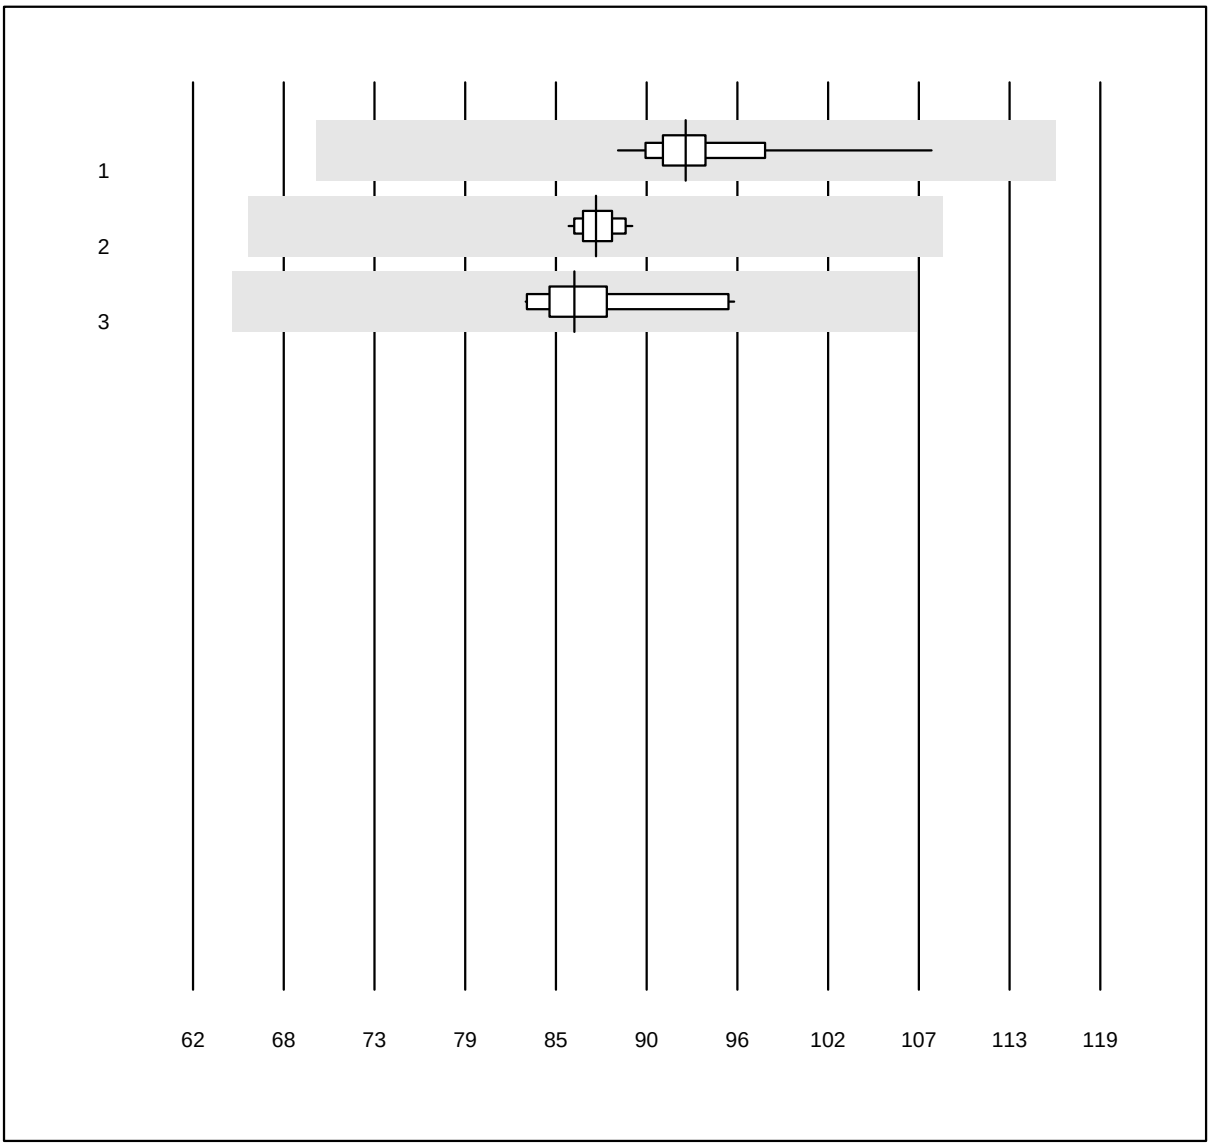


MQ Toleranz: 25%

MCV (fl)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Sysmex	132	100.0	0.0	0.0	93.0	3.6	e
2	Beckman	16	100.0	0.0	0.0	87.3	1.3	e
3	Yumizen/Pentra	11	100.0	0.0	0.0	86.0	4.9	e

MCH

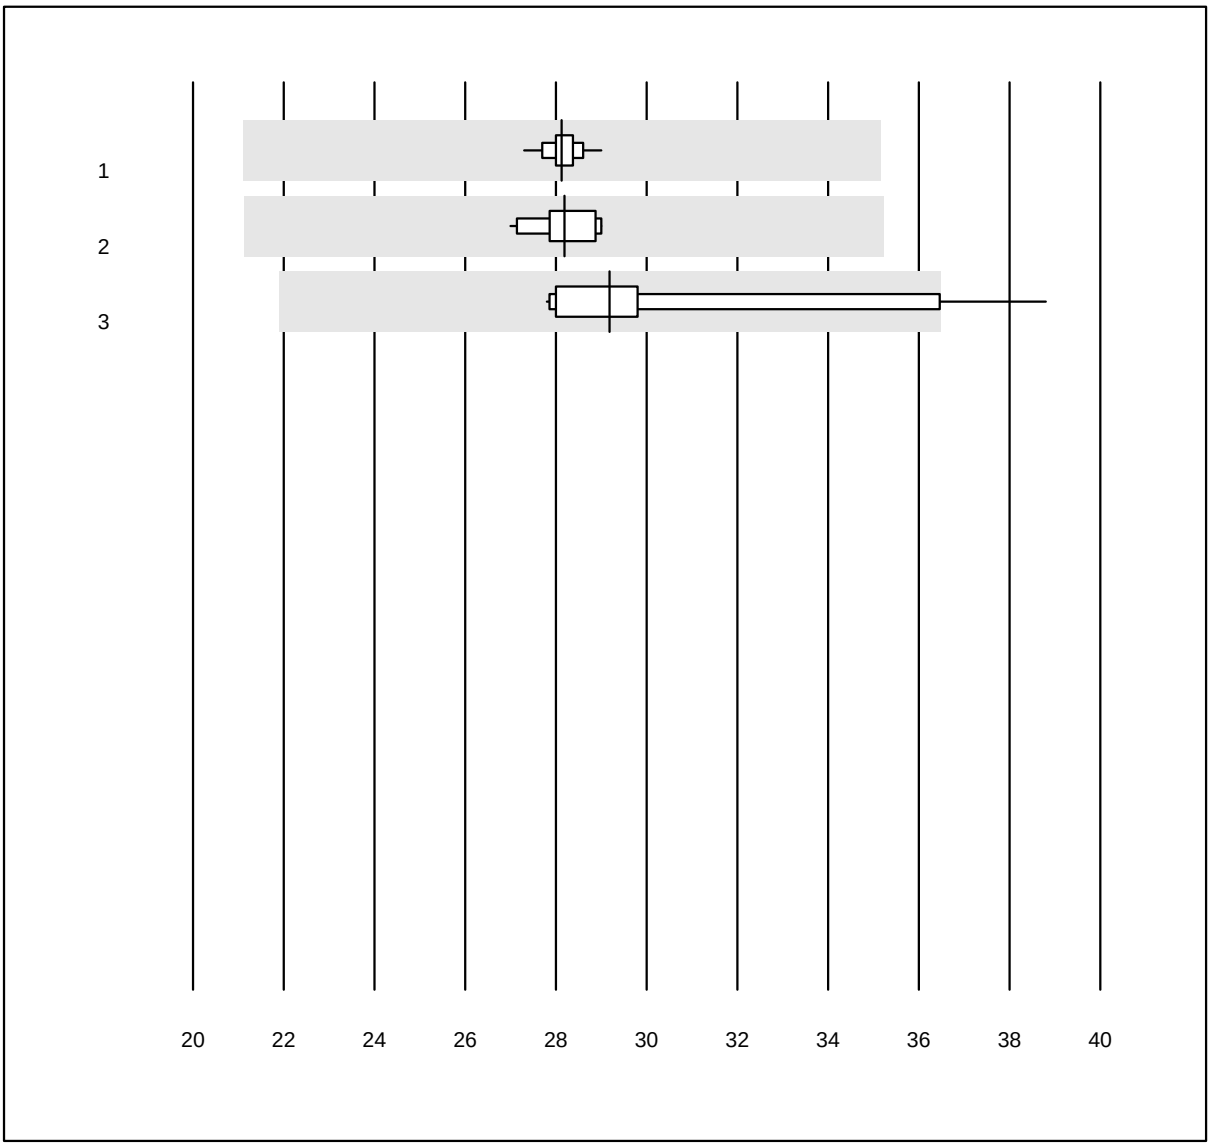


MQ Toleranz: 25%

MCH (pg)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Sysmex	132	100.0	0.0	0.0	28.1	1.3	e
2	Beckman	16	100.0	0.0	0.0	28.2	2.2	e
3	Yumizen/Pentra	12	91.7	8.3	0.0	29.2	10.0	e

MCHC

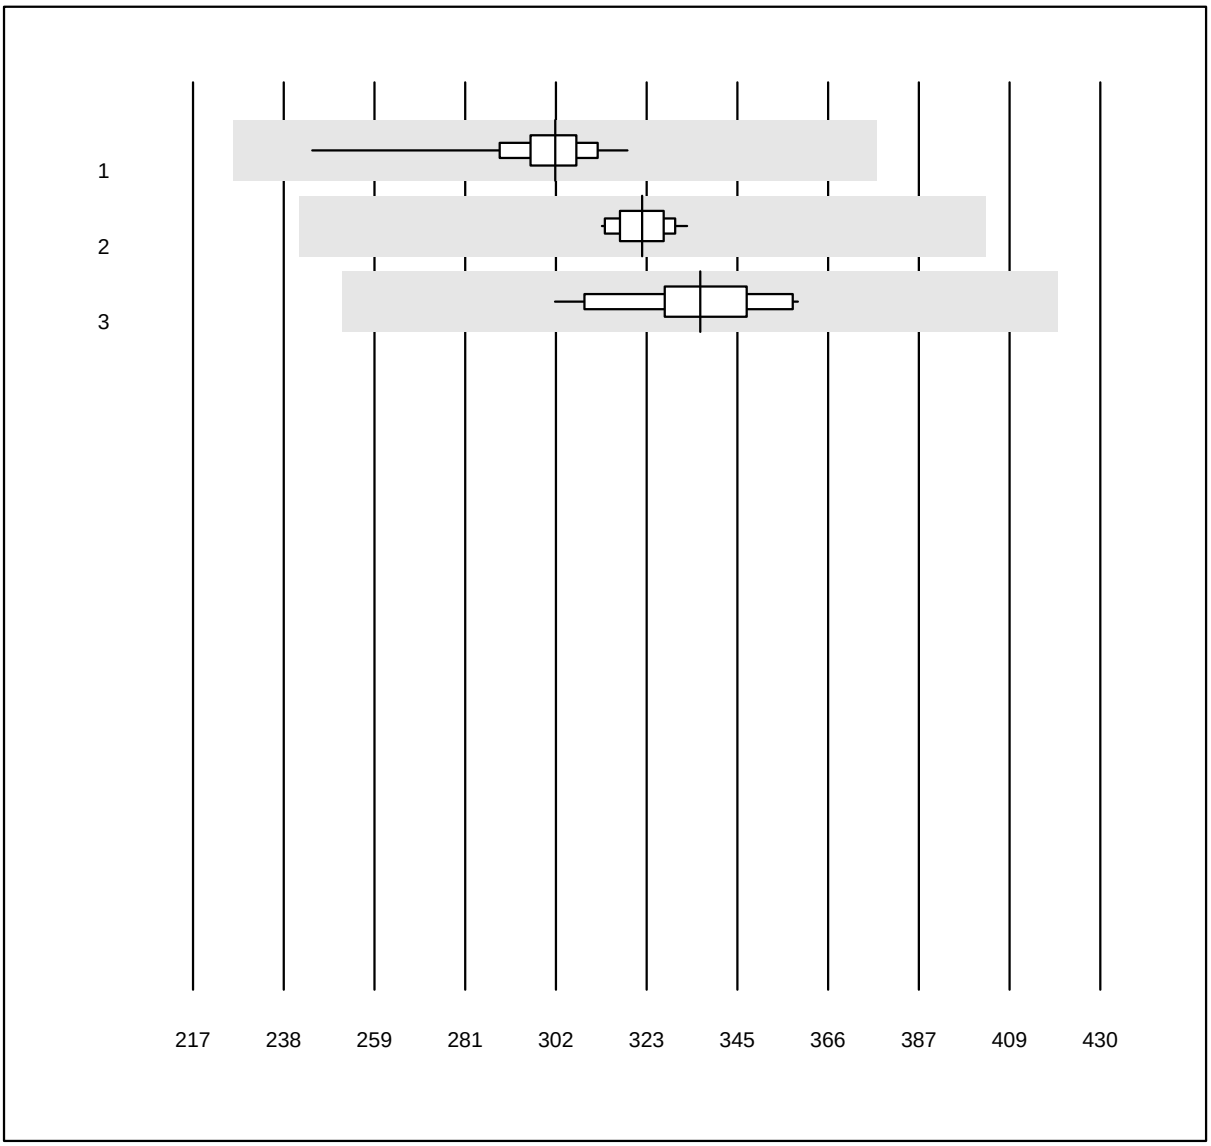


MQ Toleranz: 25%

MCHC (g/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Sysmex	133	99.2	0.0	0.8	302	3.7	e
2	Beckman	16	100.0	0.0	0.0	322	1.8	e
3	Yumizen/Pentra	12	100.0	0.0	0.0	336	4.6	e

RDW

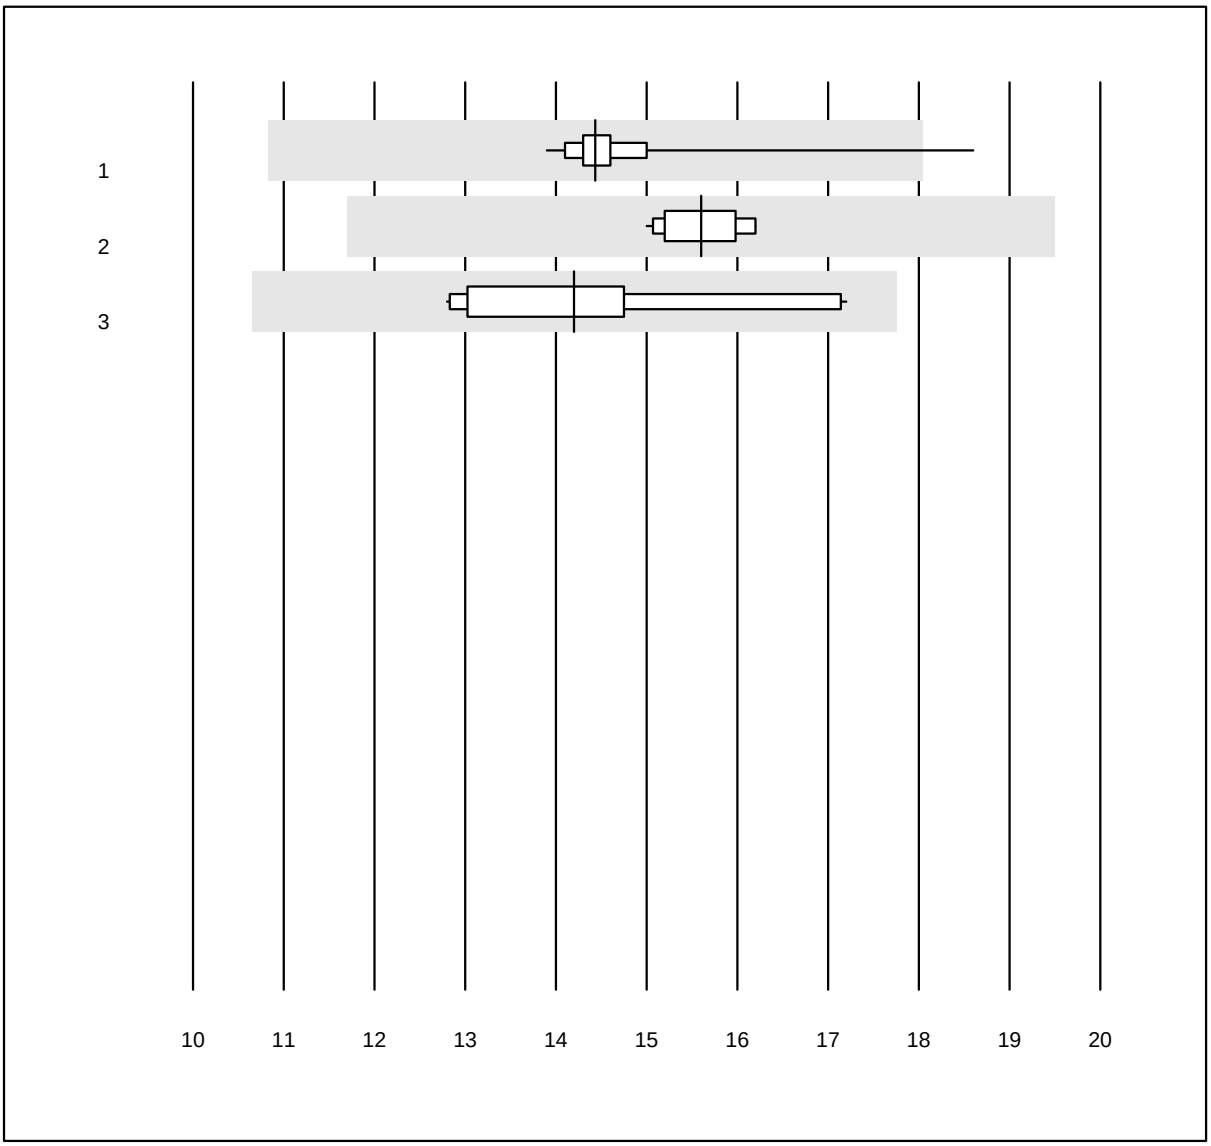


MQ Toleranz: 25%

RDW (%)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Sysmex	127	98.4	0.8	0.8	14.4	3.4	e
2	Beckman	16	100.0	0.0	0.0	15.6	2.7	e
3	Yumizen/Pentra	12	100.0	0.0	0.0	14.2	10.2	e

Réticulocytes

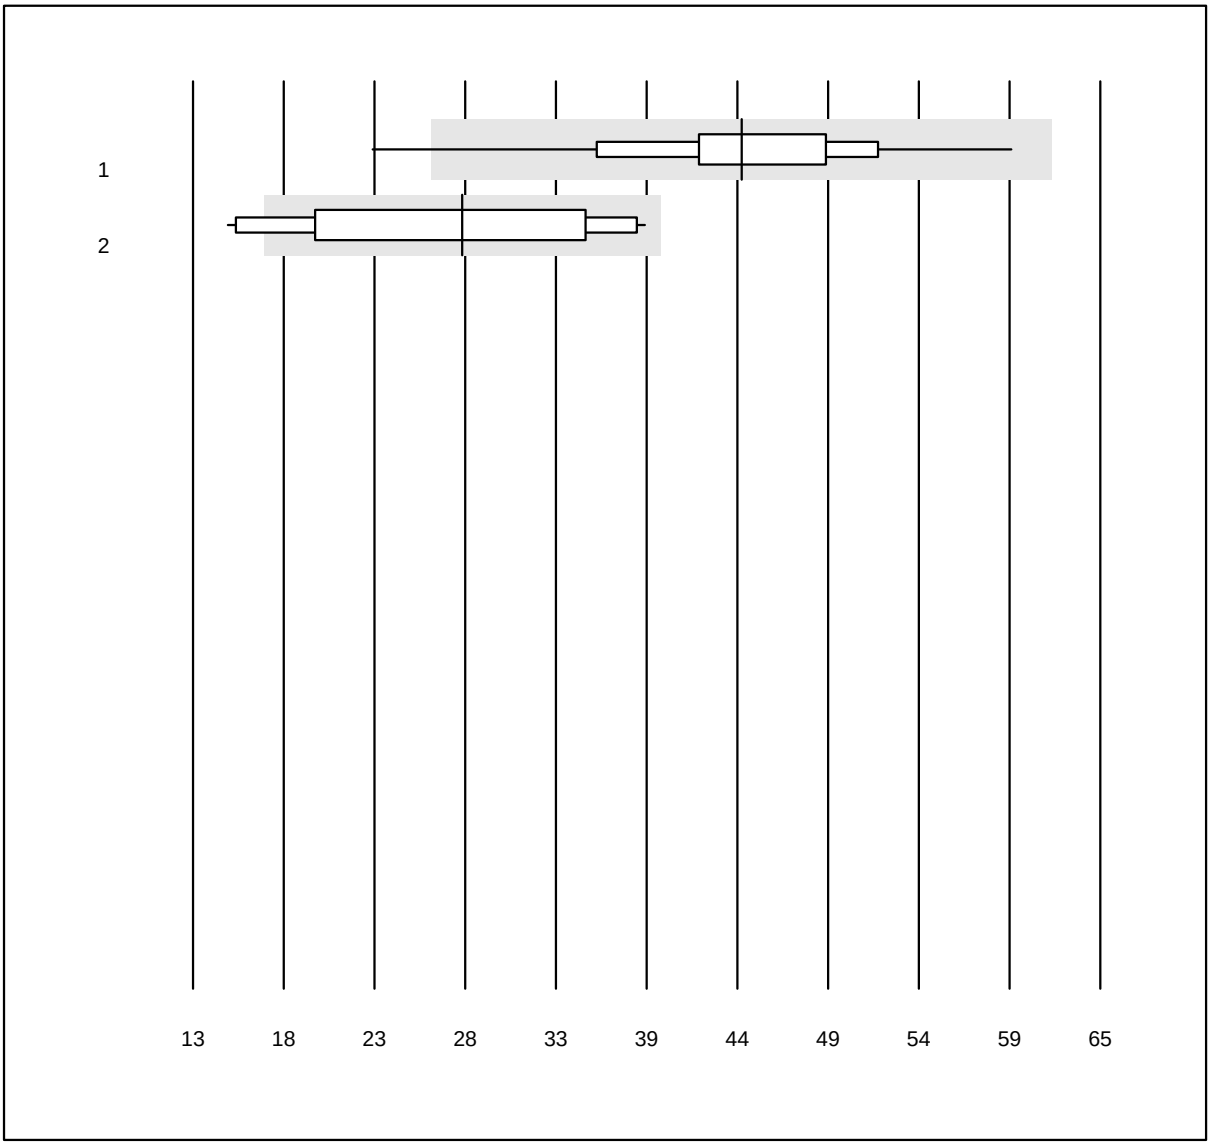


QUALAB Toleranz: 30%

Réticulocytes (G/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Sysmex	77	97.4	1.3	1.3	44.5	14.9	a
2	Beckman	11	90.9	9.1	0.0	28.4	28.6	a*

Index hémolytique A

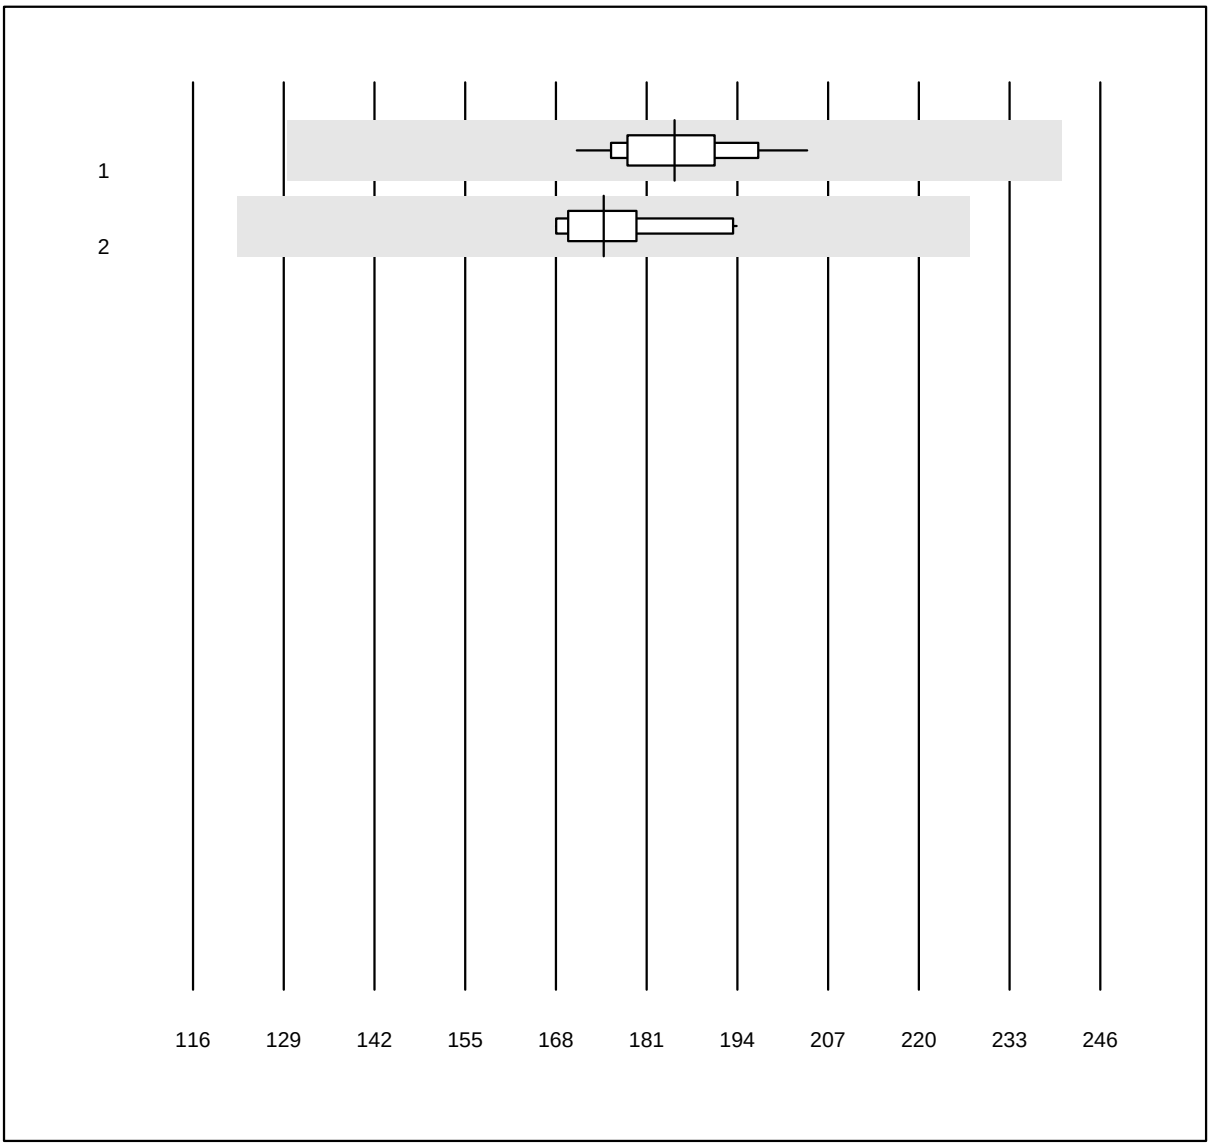


MQ Toleranz: 30%

Index hémolytique A ()

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	28	100.0	0.0	0.0	185.00	4.5	e
2	Atellica	10	100.0	0.0	0.0	174.86	4.9	e

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Index hémolytique B

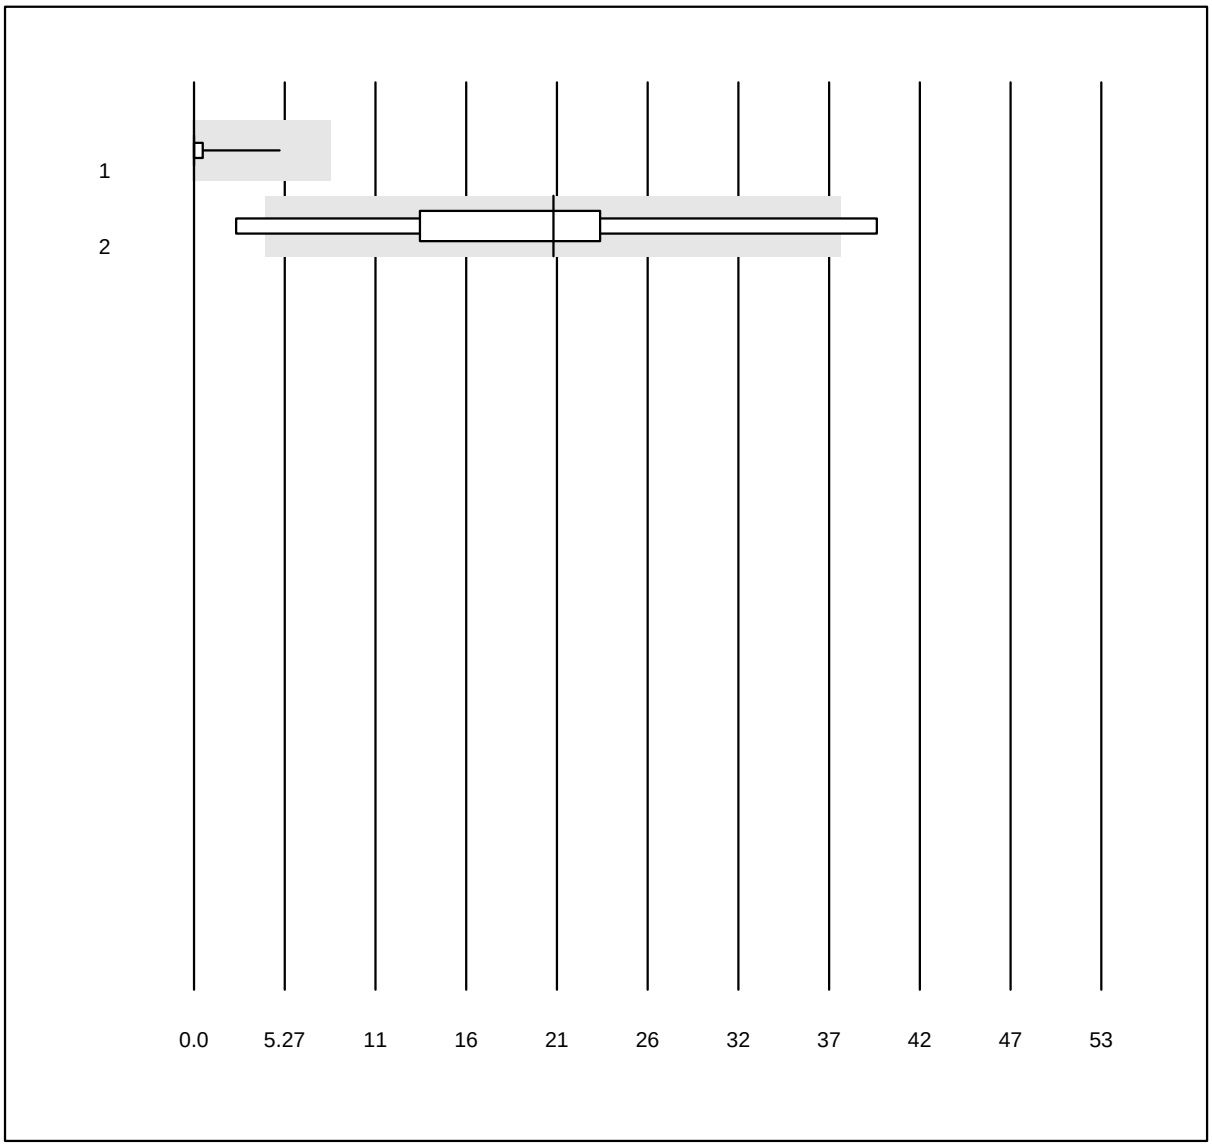


MQ Toleranz: 30%
(< 20.0: +/- 8.0)

Index hémolytique B ()

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	28	100.0	0.0	0.0	0.00	366.0	e
2	Atellica	10	70.0	0.0	30.0	21.00	56.4	a*

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Indice d'ictère A

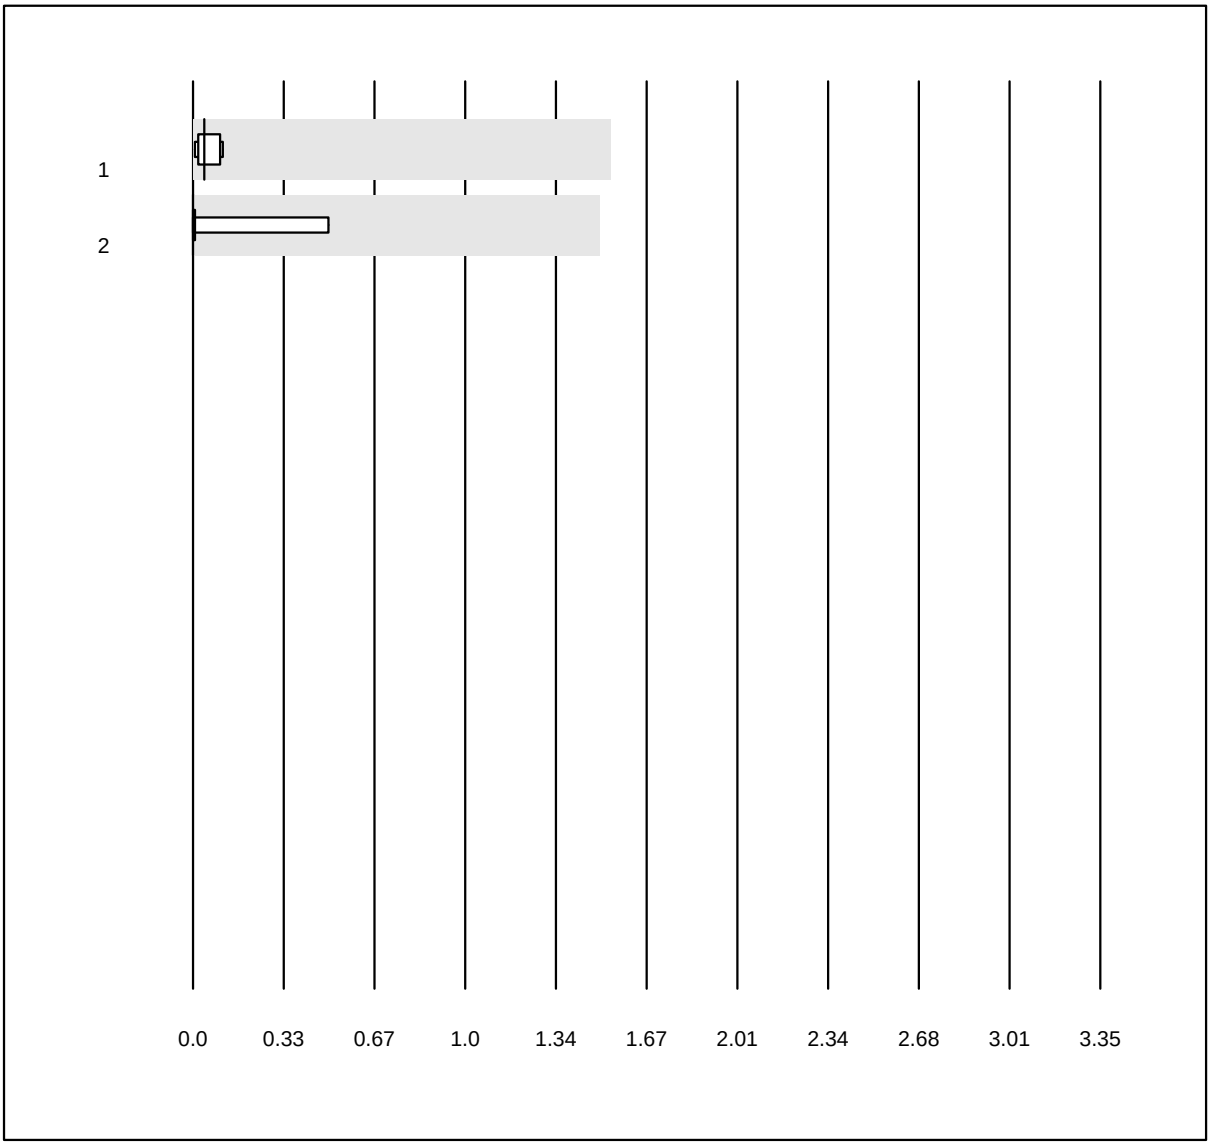


MQ Toleranz: 30%
(< 5.0: +/- 1.5)

Indice d'ictère A ()

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Atellica	9	100.0	0.0	0.0	0.04	73.8	e
2	Cobas	16	100.0	0.0	0.0	0.00	267.2	e

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Indice d'ictère B

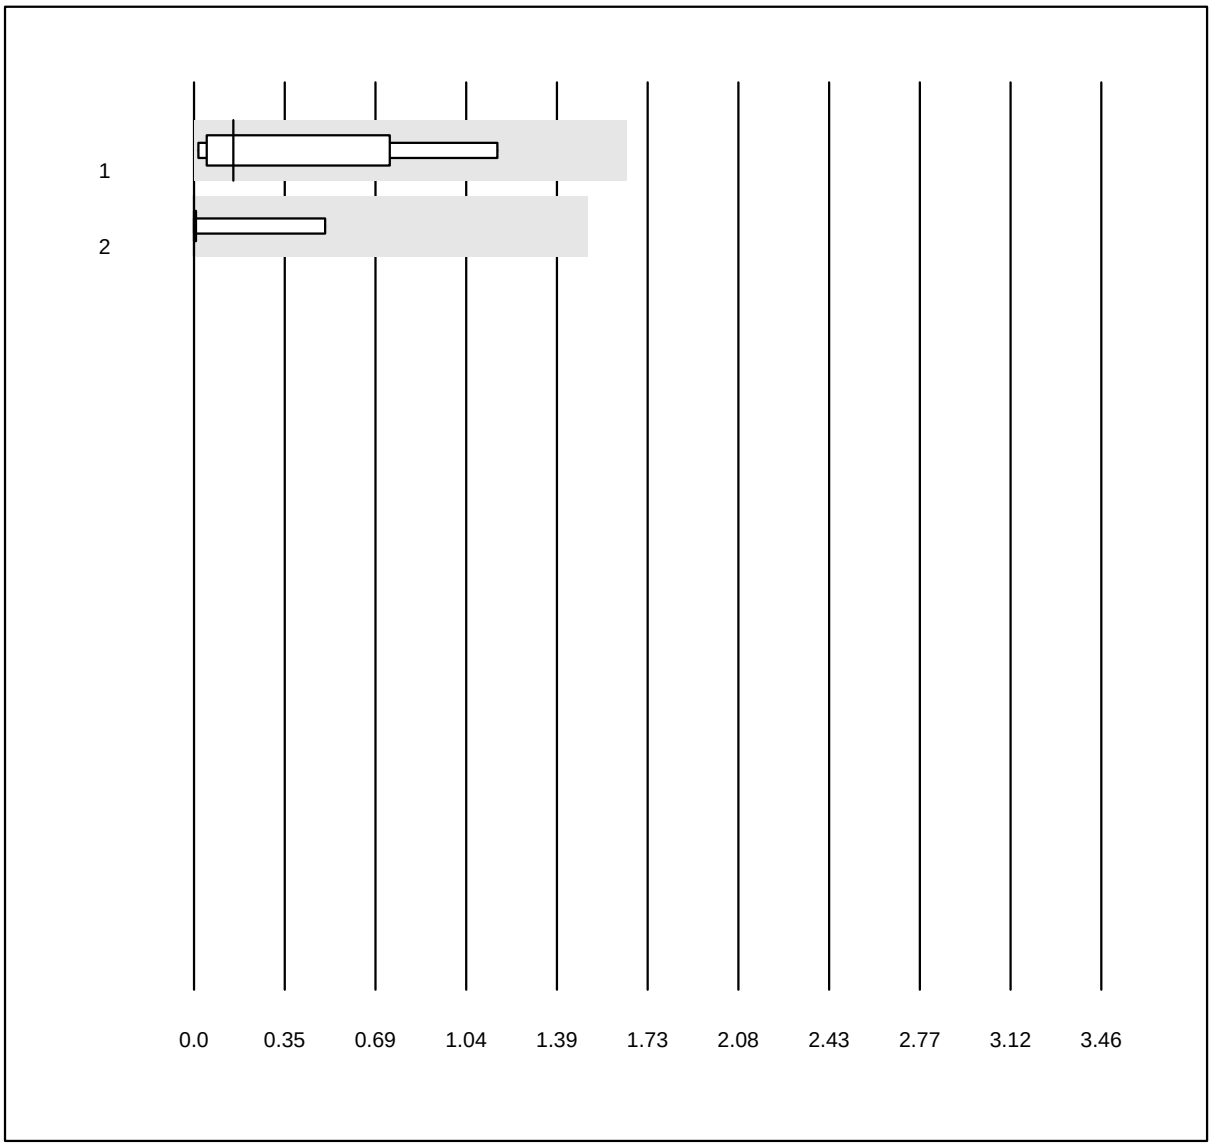


MQ Toleranz: 30%
(< 5.0: +/- 1.5)

Indice d'ictère B ()

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Atellica	9	100.0	0.0	0.0	0.15	127.0	e
2	Cobas	16	100.0	0.0	0.0	0.00	267.2	e

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Indice de lipémie A

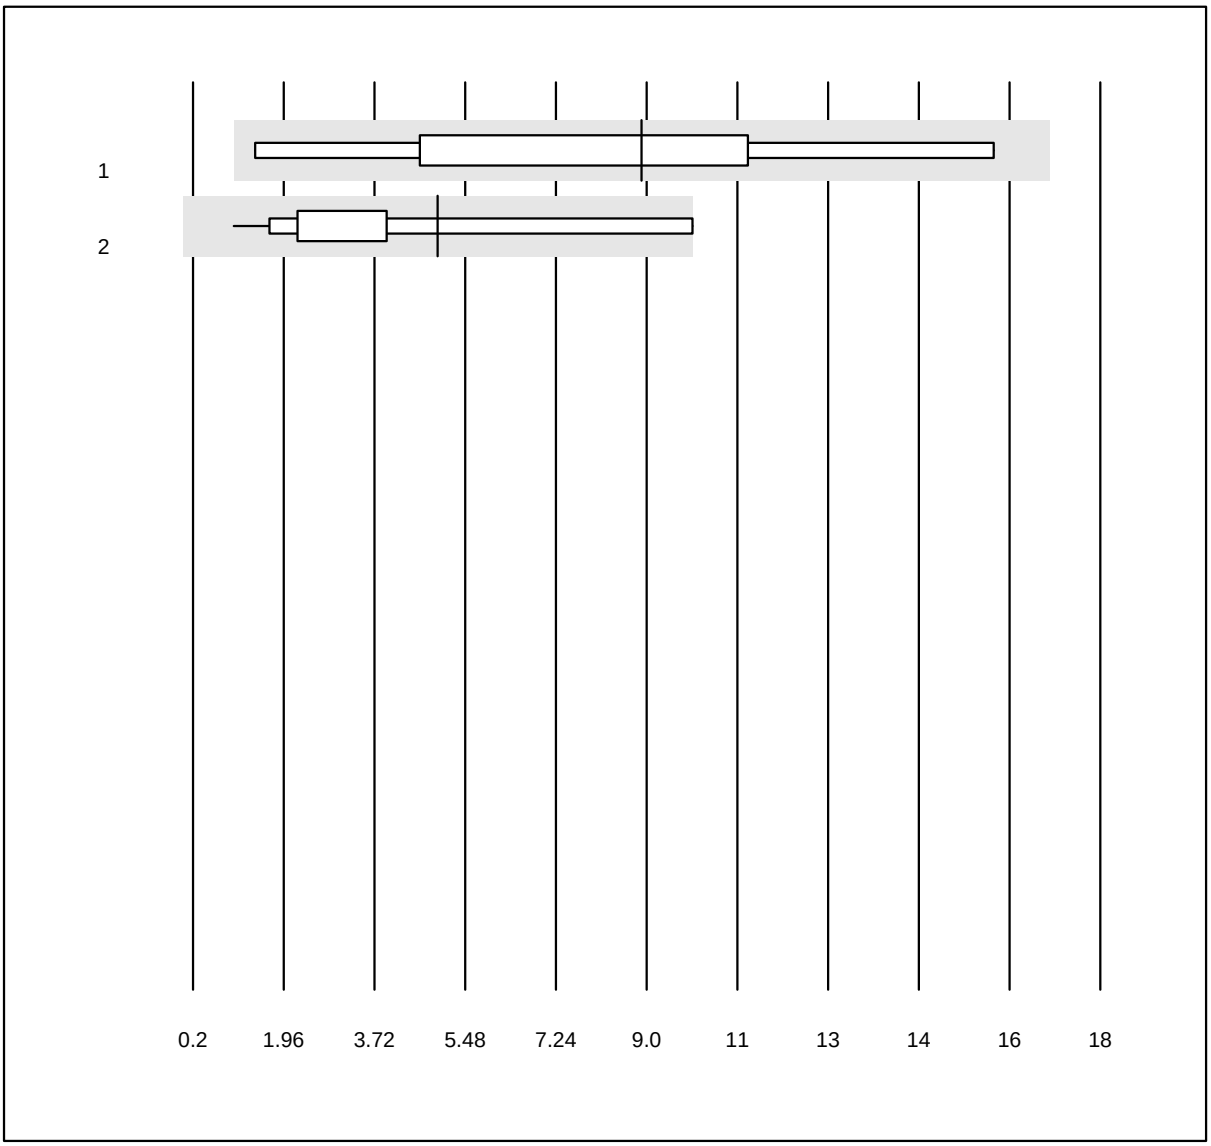


MQ Toleranz: 30%
(< 10.0: +/- 8.0)

Indice de lipémie A ()

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Atellica	9	100.0	0.0	0.0	9.00	51.7	a*
2	Cobas	16	100.0	0.0	0.0	5.00	67.9	a*

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Indice de lipémie B

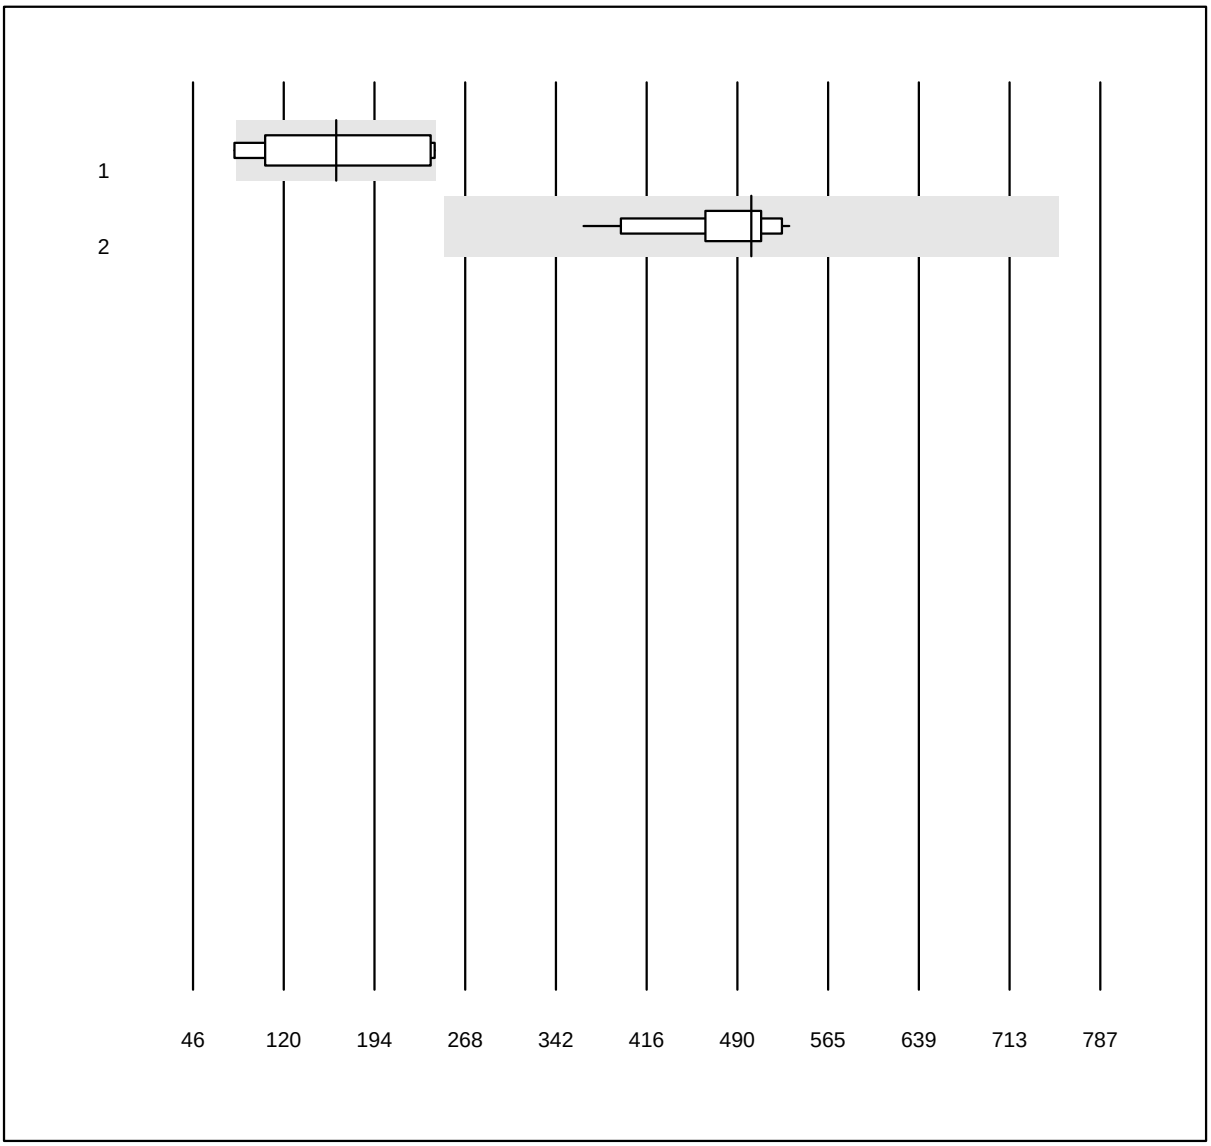


MQ Toleranz: 30%

Indice de lipémie B ()

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Atellica	9	88.9	11.1	0.0	163.00	40.1	a*
2	Cobas	16	87.5	0.0	12.5	502.00	9.1	a

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Vitesse de sédimentation 1h

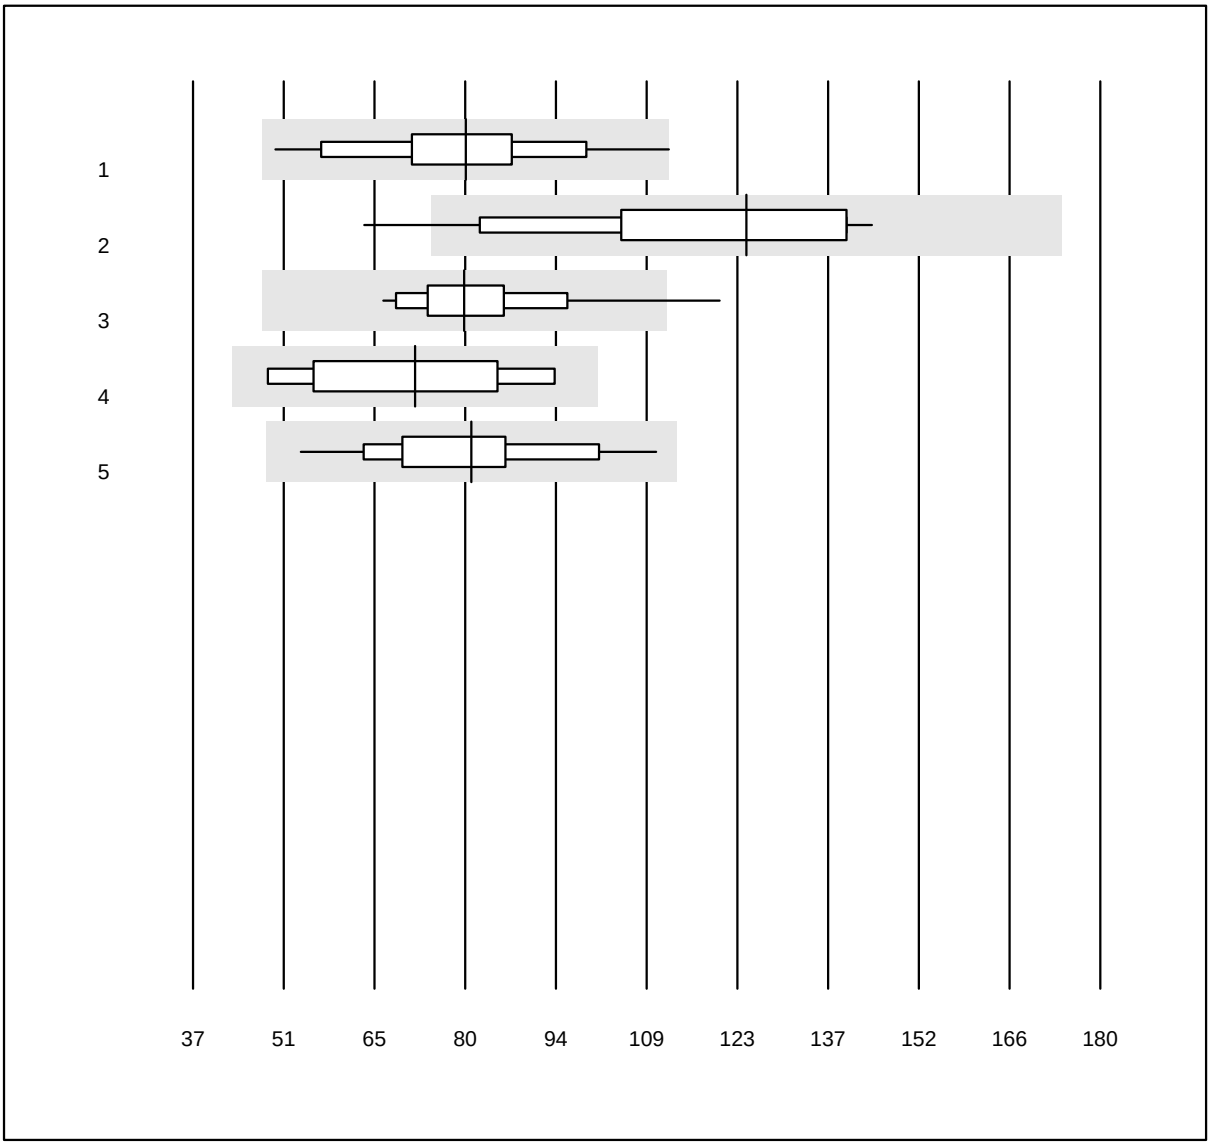


MQ Toleranz: 40%

Vitesse de sédimentation 1h (mm/h)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Sarstedt Sedivette	30	100.0	0.0	0.0	80	17.1	a
2	MINI-CUBE	41	95.1	4.9	0.0	124	18.6	e
3	BD Seditainer	40	95.0	2.5	2.5	80	13.9	e
4	Sarstedt Microvette	5	100.0	0.0	0.0	72	21.5	e*
5	Autres méthodes	19	94.7	0.0	5.3	81	16.5	e

Vitesse de sédimentation 2h

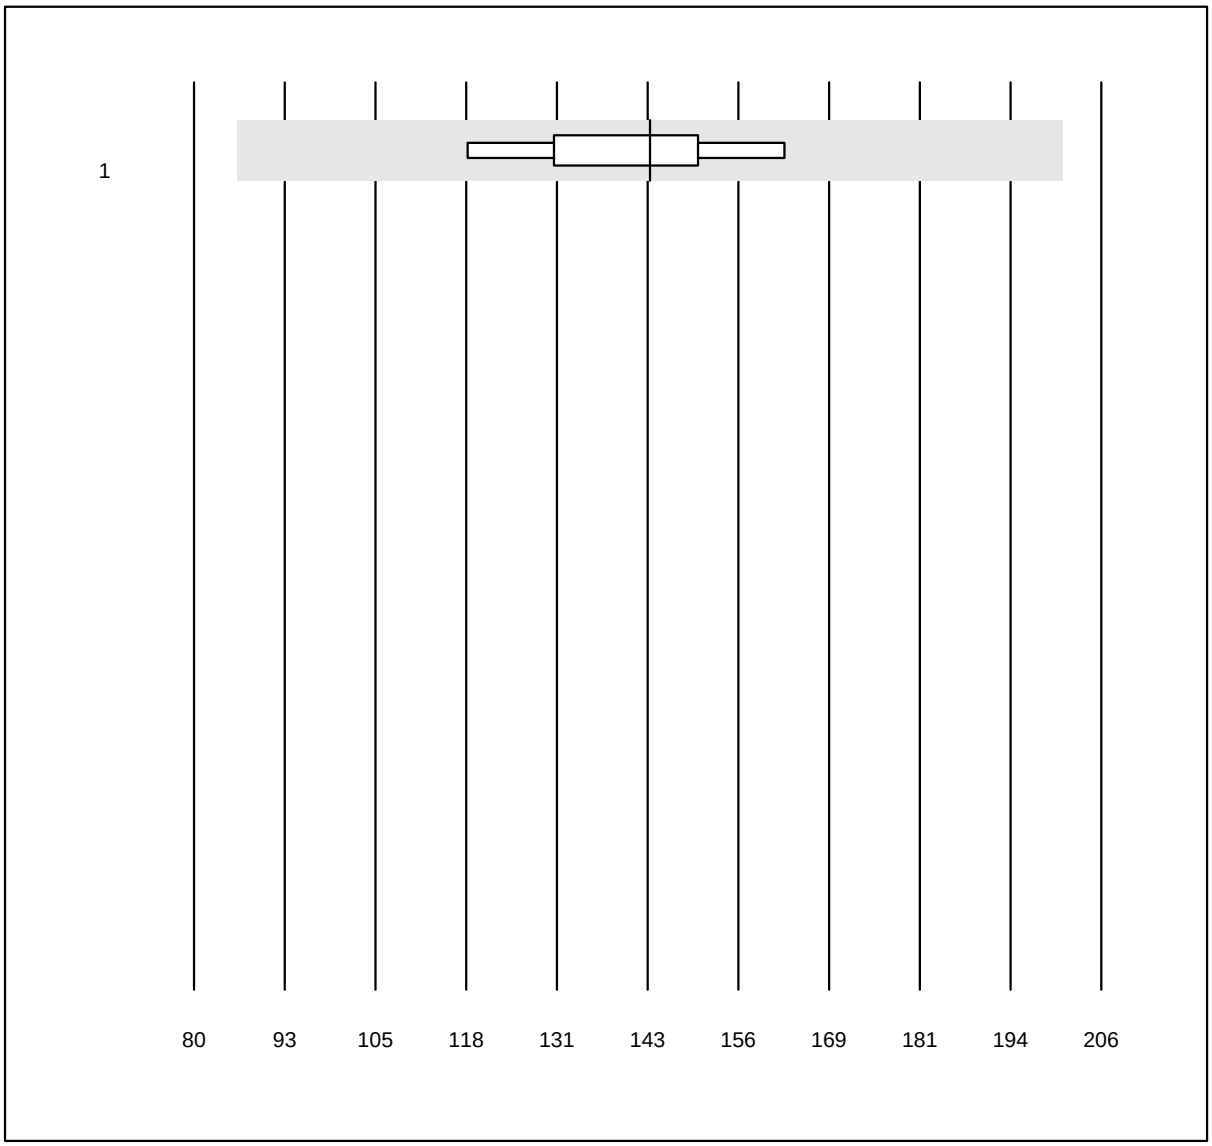


MQ Toleranz: 40%

Vitesse de sédimentation
2h (mm/2h)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Sarstedt Sedivette	7	100.0	0.0	0.0	143	9.5	e

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Hémoglobine HS

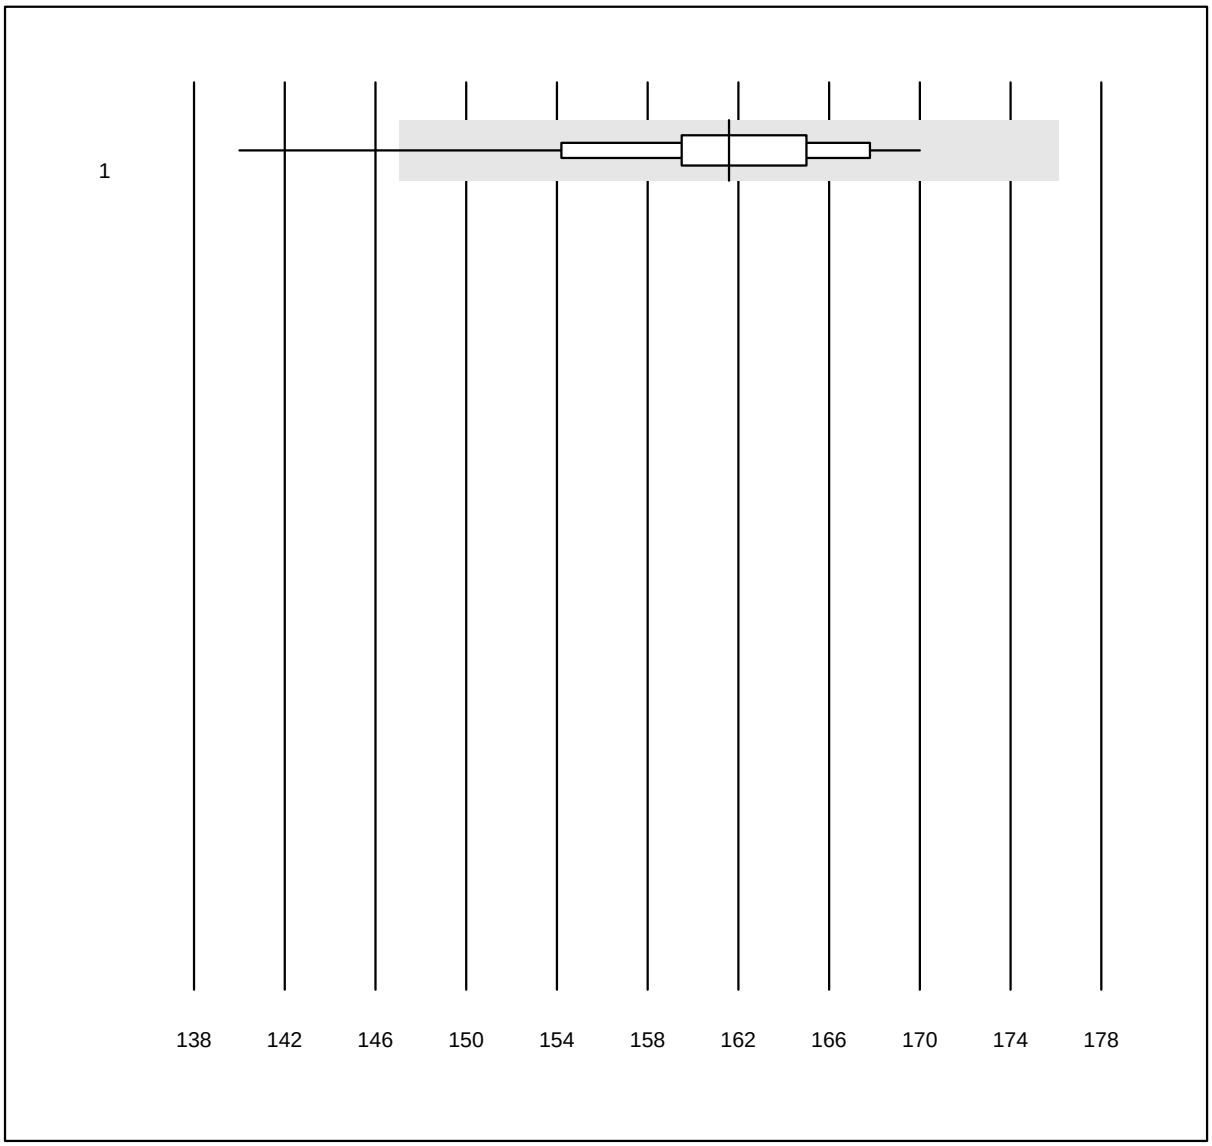


QUALAB Toleranz: 9%

Hémoglobine HS (g/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	PixCell HemoScreen	44	90.9	2.3	6.8	161.6	3.5	e

Hématocrit HS

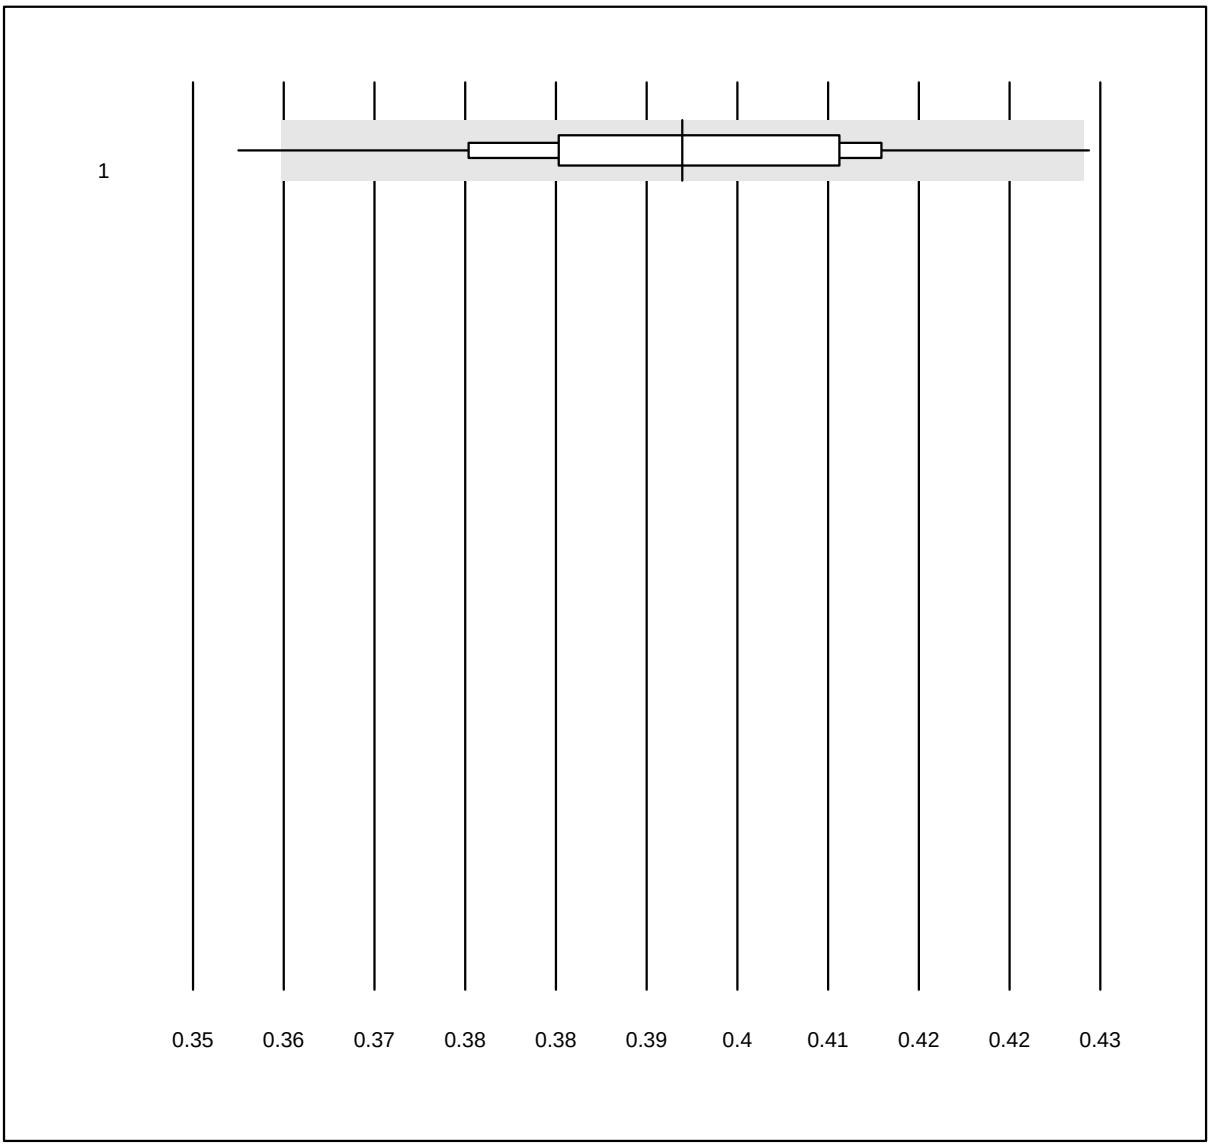


QUALAB Toleranz: 9%

Hématocrit HS (l/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	PixCell HemoScreen	44	90.9	4.5	4.5	0.4	4.0	e

Erythrocytes HS

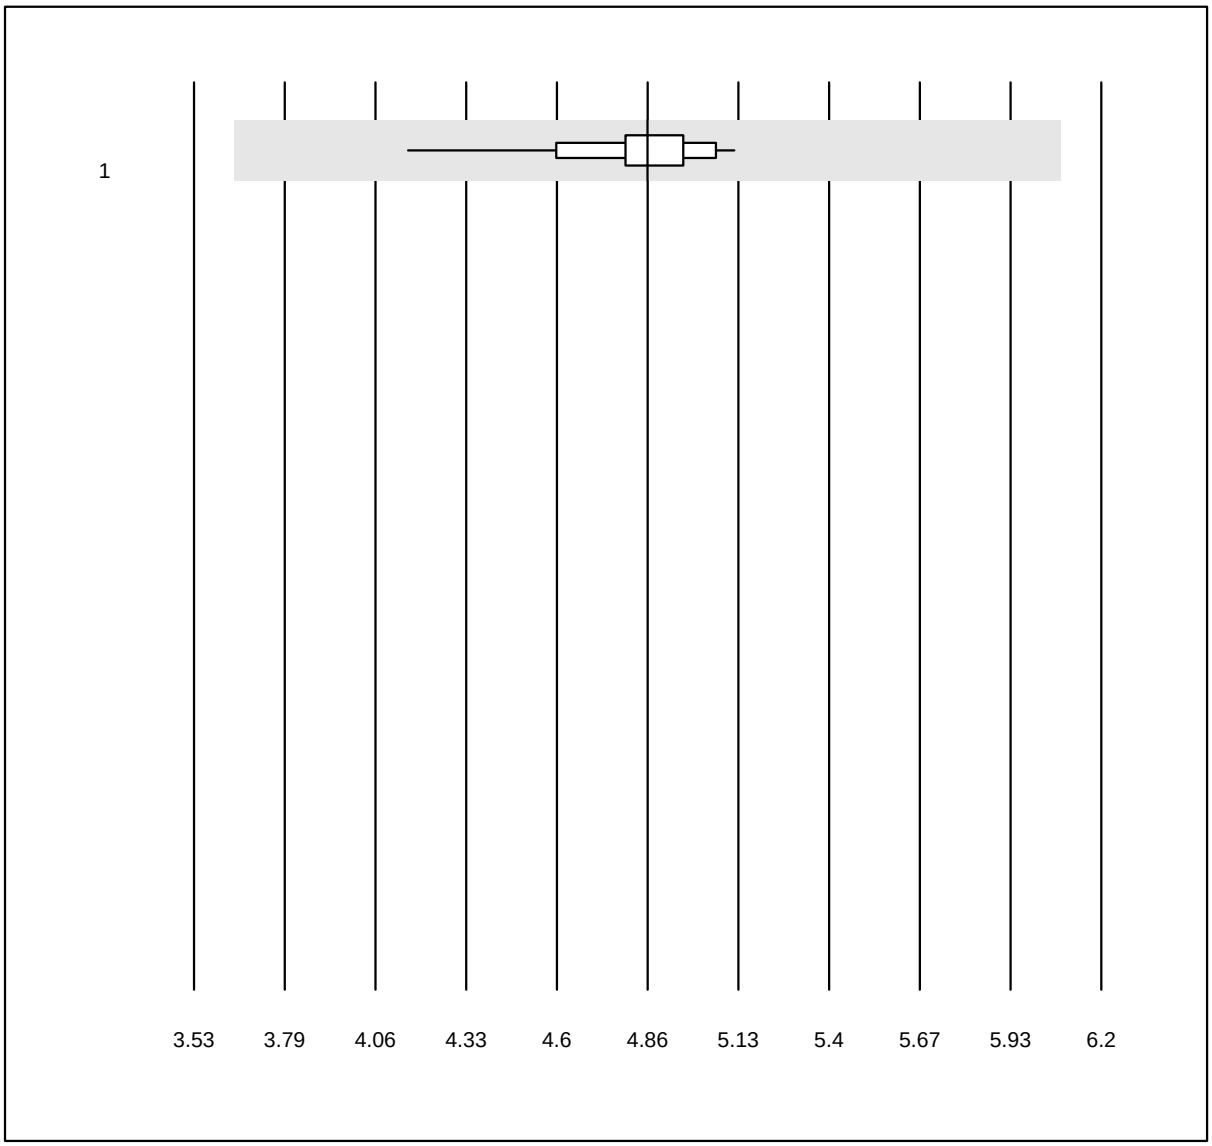


QUALAB Toleranz: 25%

Erythrocytes HS (T/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	PixCell HemoScreen	44	97.7	0.0	2.3	4.86	4.1	e

Leucocytes HS

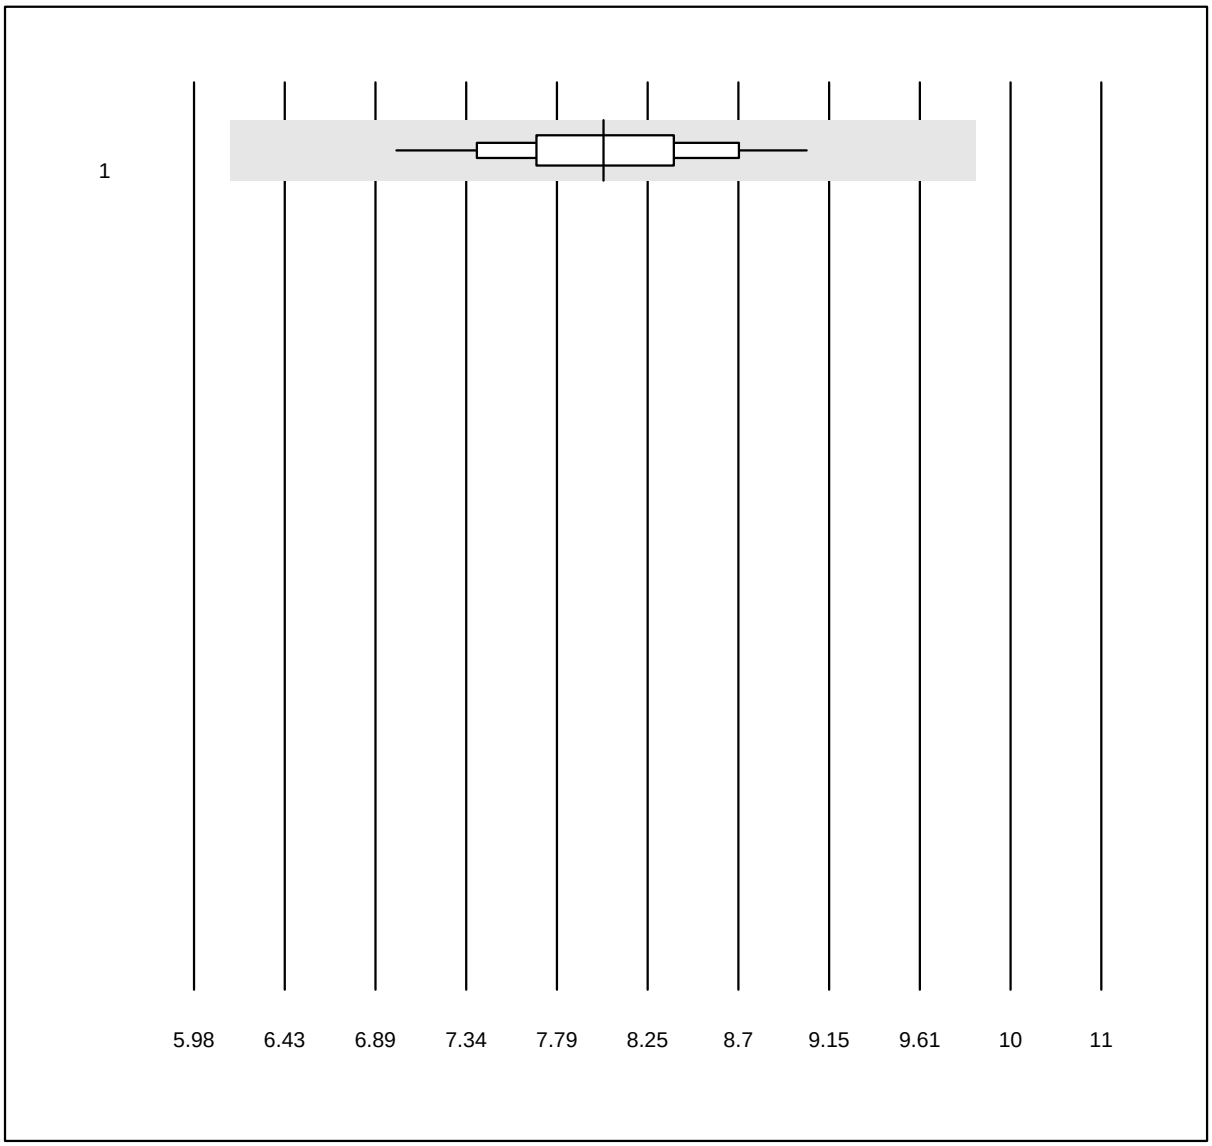


QUALAB Toleranz: 25%

Leucocytes HS (G/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	PixCell HemoScreen	44	100.0	0.0	0.0	8.25	6.3	e

Thrombocytes HS

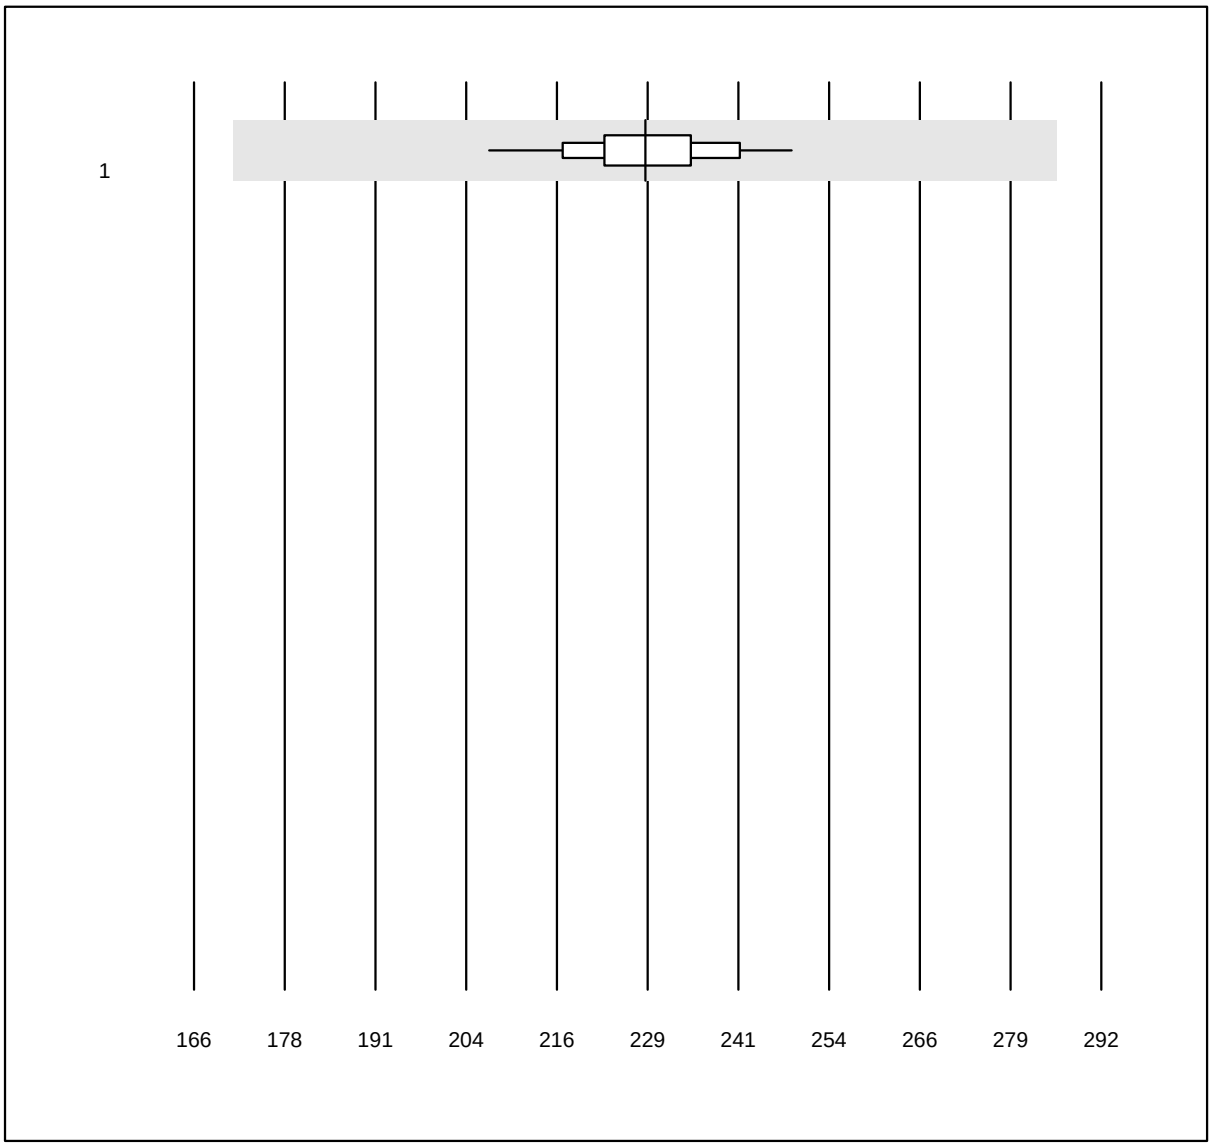


QUALAB Toleranz: 25%

Thrombocytes HS (G/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	PixCell HemoScreen	43	100.0	0.0	0.0	228.7	3.9	e

Erythrocytes BF

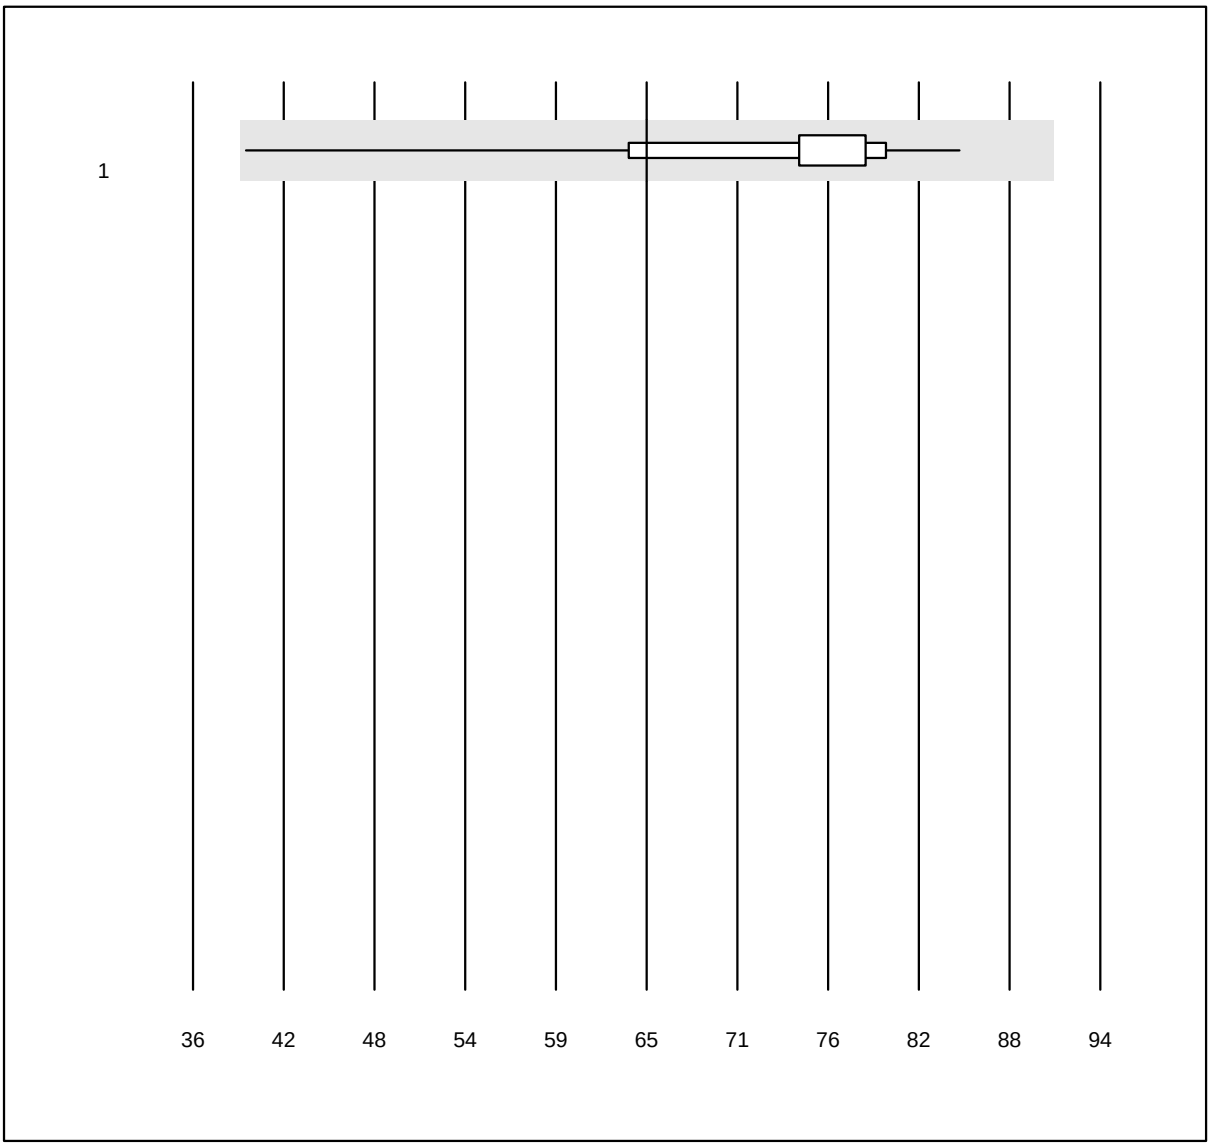


MQ Toleranz: 40%

Erythrocytes BF (G/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Sysmex	46	100.0	0.0	0.0	65.000	10.6	a

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Leucocytes BF

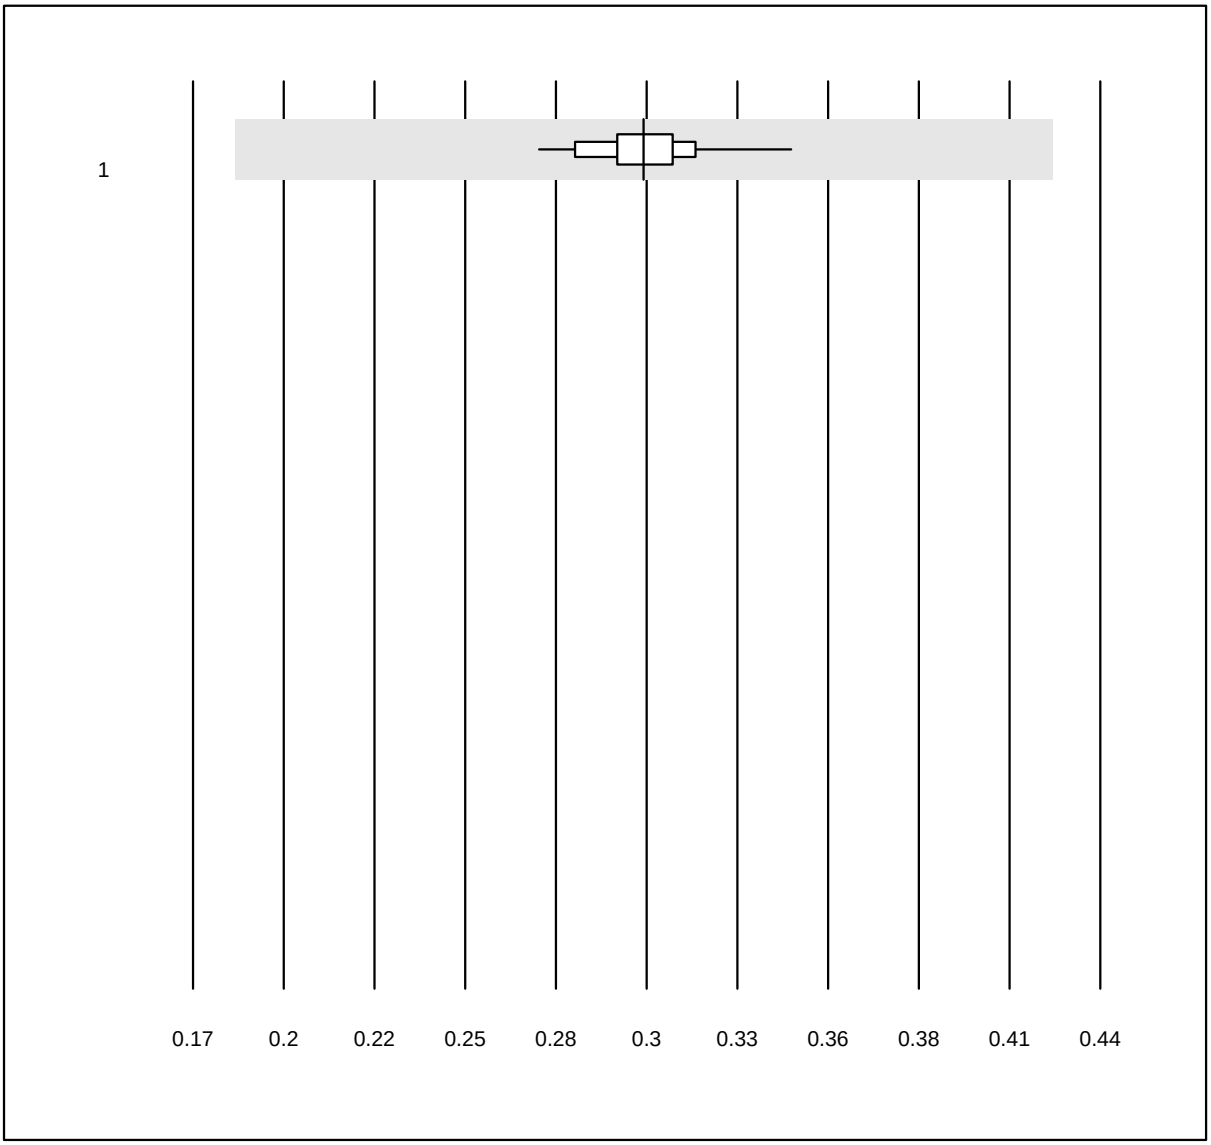


MQ Toleranz: 40%

Leucocytes BF (G/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Sysmex	48	100.0	0.0	0.0	0.304	4.6	e

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Cellules mononucléaires (MN)

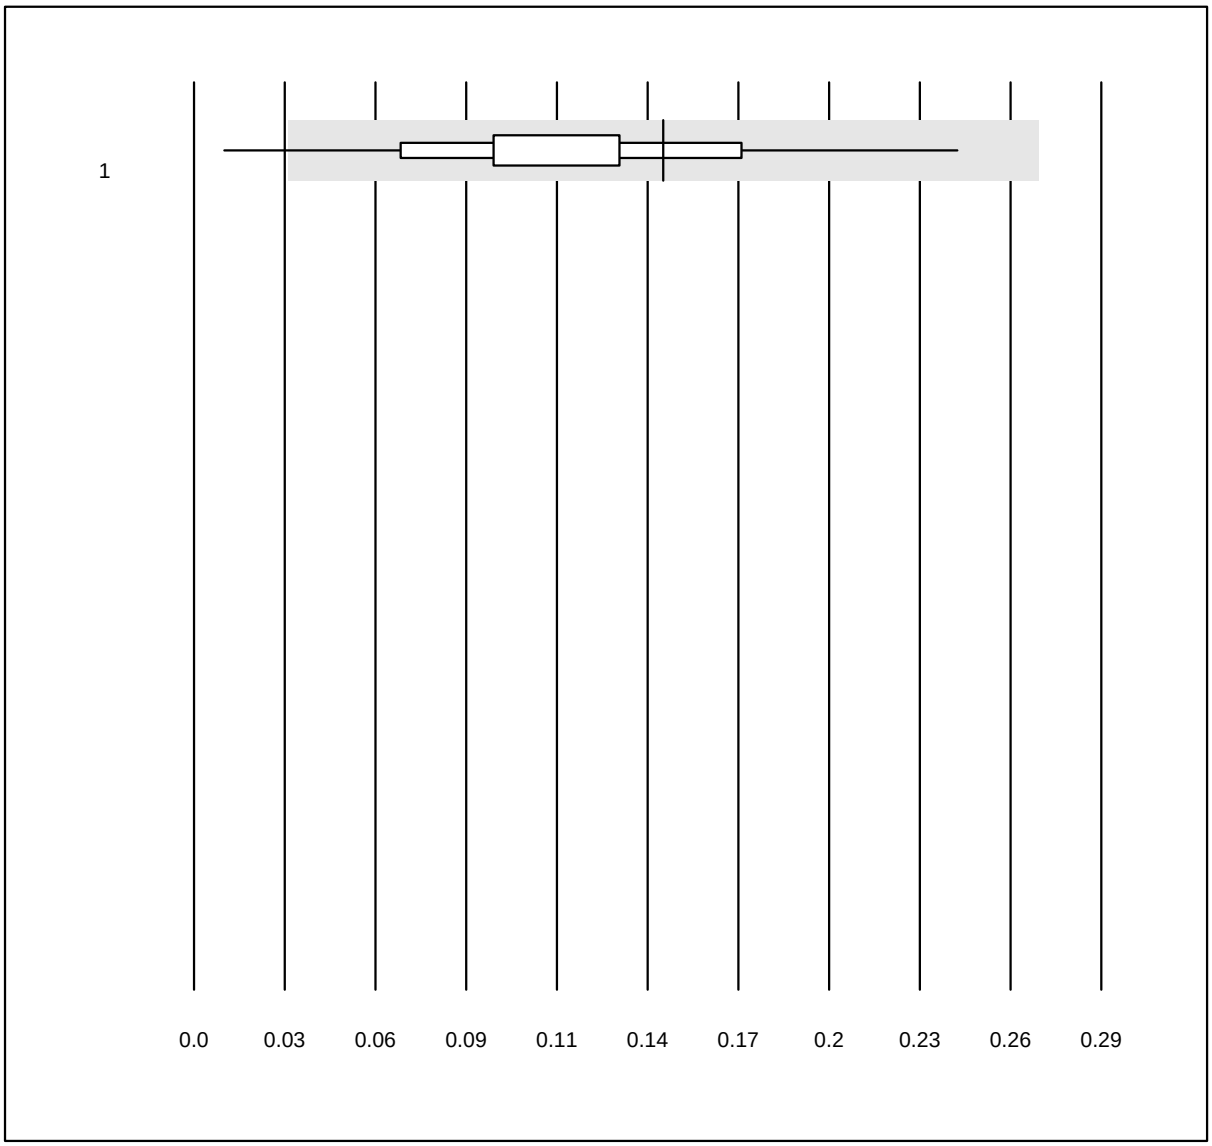


MQ Toleranz: 40%

Cellules mononucléaires (MN) (G/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Sysmex	46	97.8	2.2	0.0	0.150	39.3	a

Cellules polynucléaires (PMN)

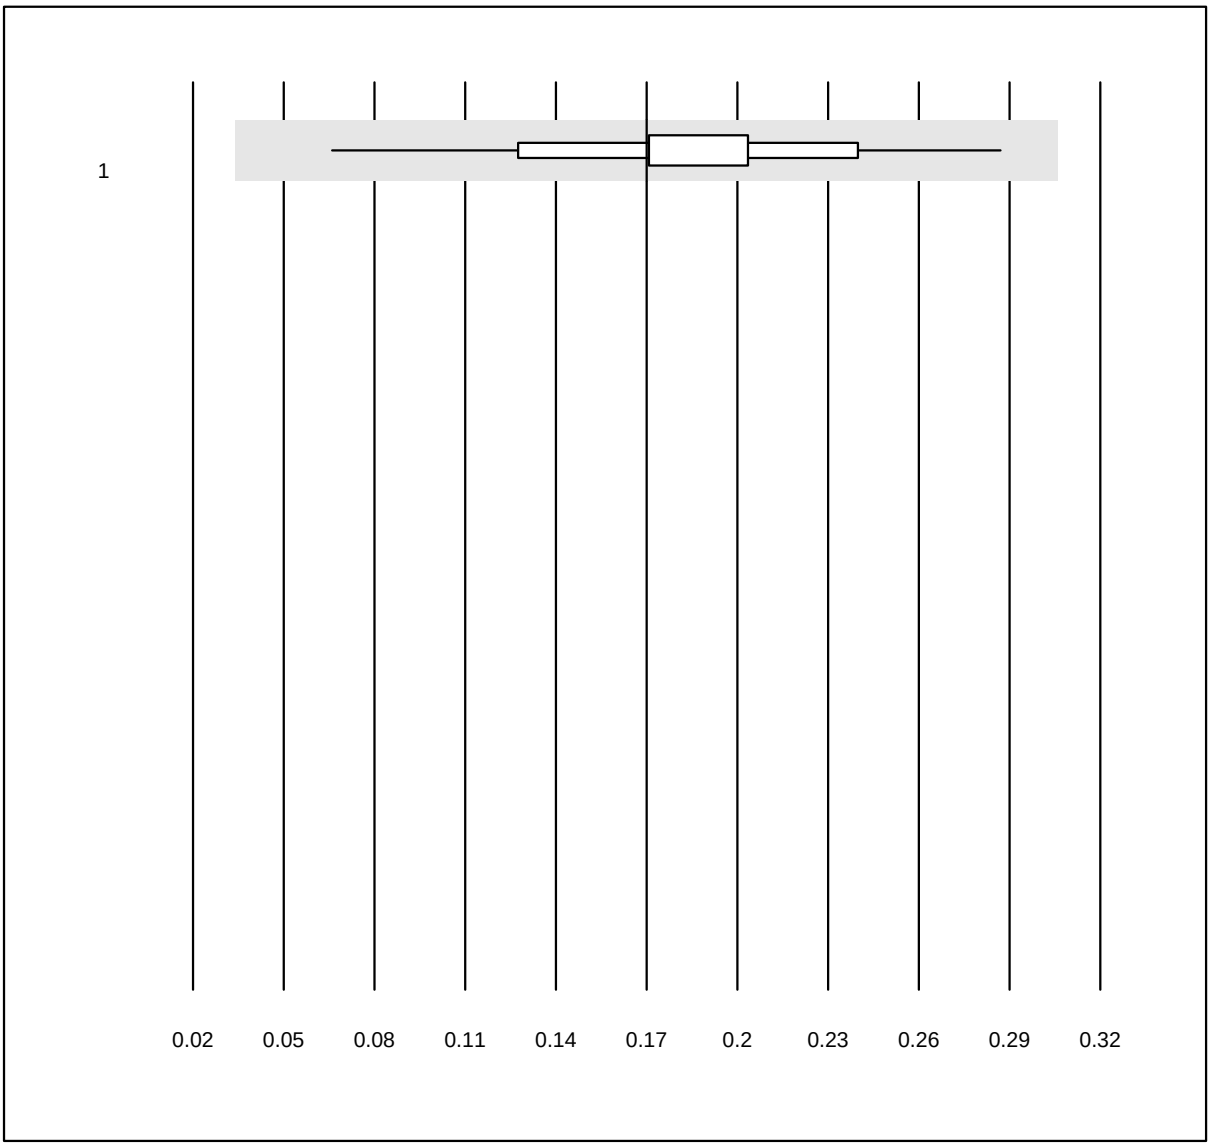


MQ Toleranz: 40%

Cellules polynucléaires (PMN) (G/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Sysmex	46	100.0	0.0	0.0	0.170	24.9	a

Cellules total (TC)

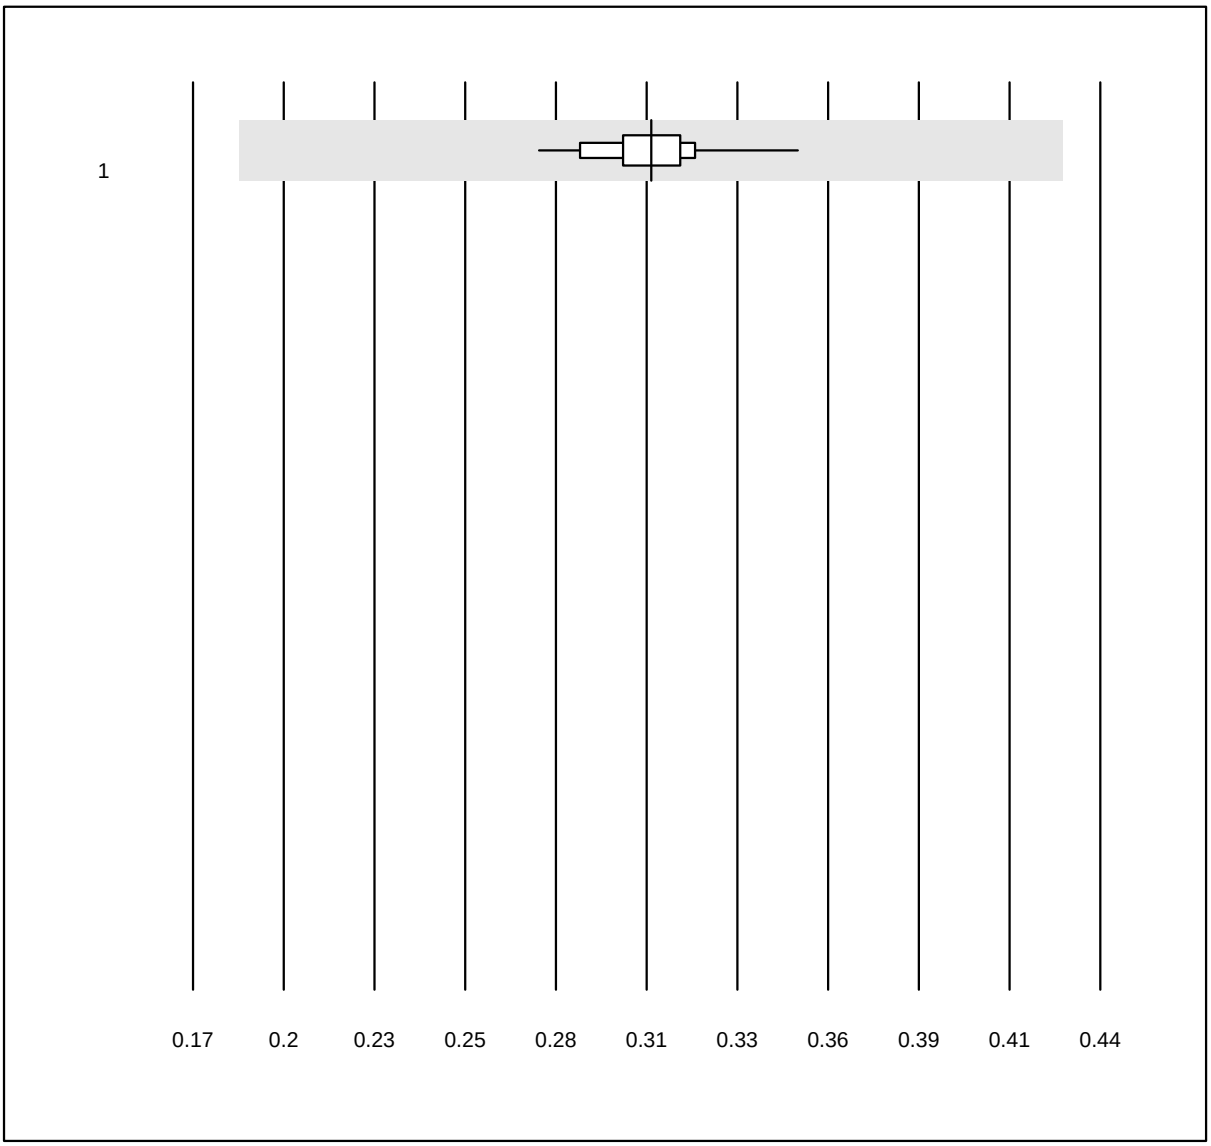


MQ Toleranz: 40%

Cellules total (TC) (G/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Sysmex	41	100.0	0.0	0.0	0.306	4.6	e

Vitesse de sédimentation

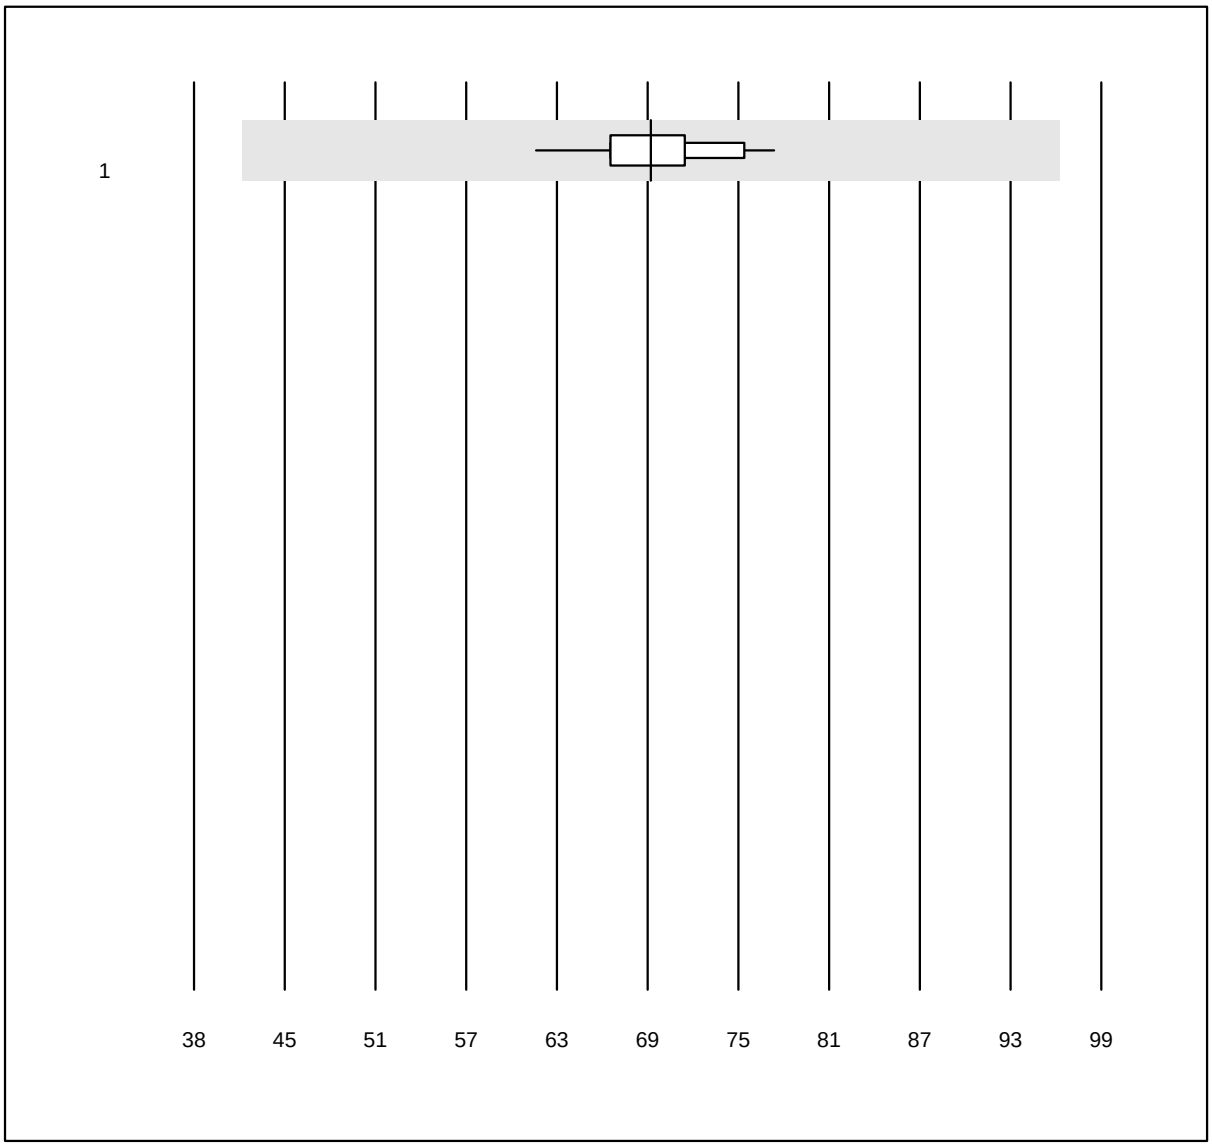


MQ Toleranz: 40%

Vitesse de sédimentation (mm/h)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	miniiSed	30	96.7	0.0	3.3	69	5.1	e

CRP 1

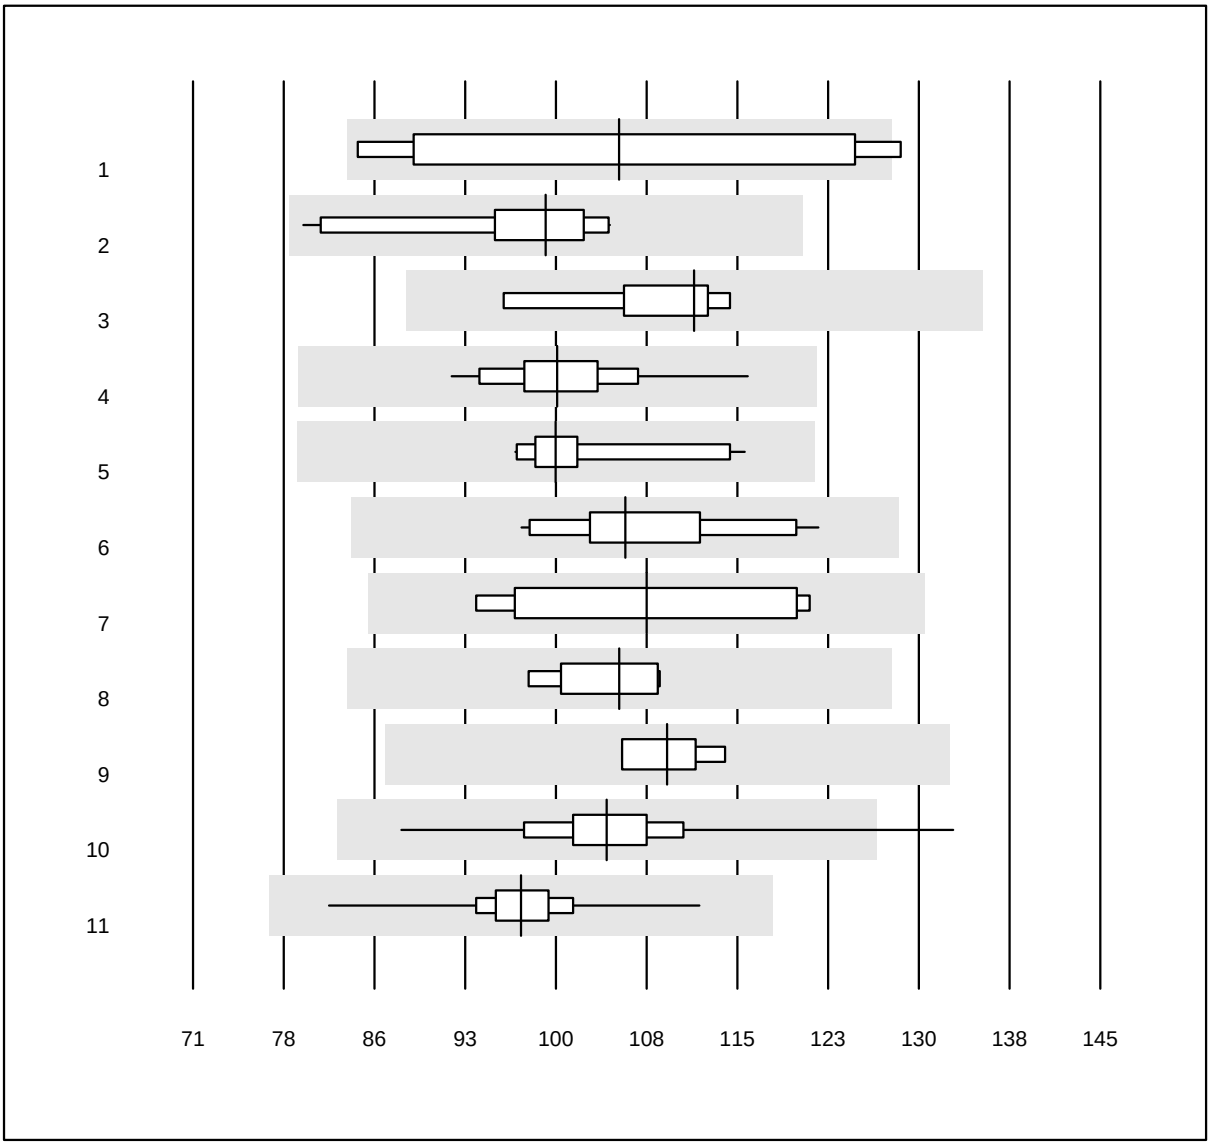


QUALAB Toleranz: 21%

CRP (mg/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Vitros	7	85.7	14.3	0.0	105.8	16.2	e*
2	Abbott	10	100.0	0.0	0.0	99.8	7.5	e
3	Beckman	5	100.0	0.0	0.0	111.9	4.8	e
4	Roche	50	96.0	0.0	4.0	100.7	5.2	e
5	Siemens	10	100.0	0.0	0.0	100.6	5.3	e
6	Autolyser	14	85.7	0.0	14.3	106.3	6.2	e
7	Fuji Dri-Chem	10	60.0	0.0	40.0	108.0	10.6	a*
8	Spotchem D-Concept	5	100.0	0.0	0.0	105.8	3.9	e
9	Piccolo	7	100.0	0.0	0.0	109.7	2.9	e
10	Afinion	979	99.5	0.2	0.3	104.7	5.1	e
11	Cobas b101/Click	487	99.2	0.0	0.8	97.8	3.6	e

4 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

CRP 2

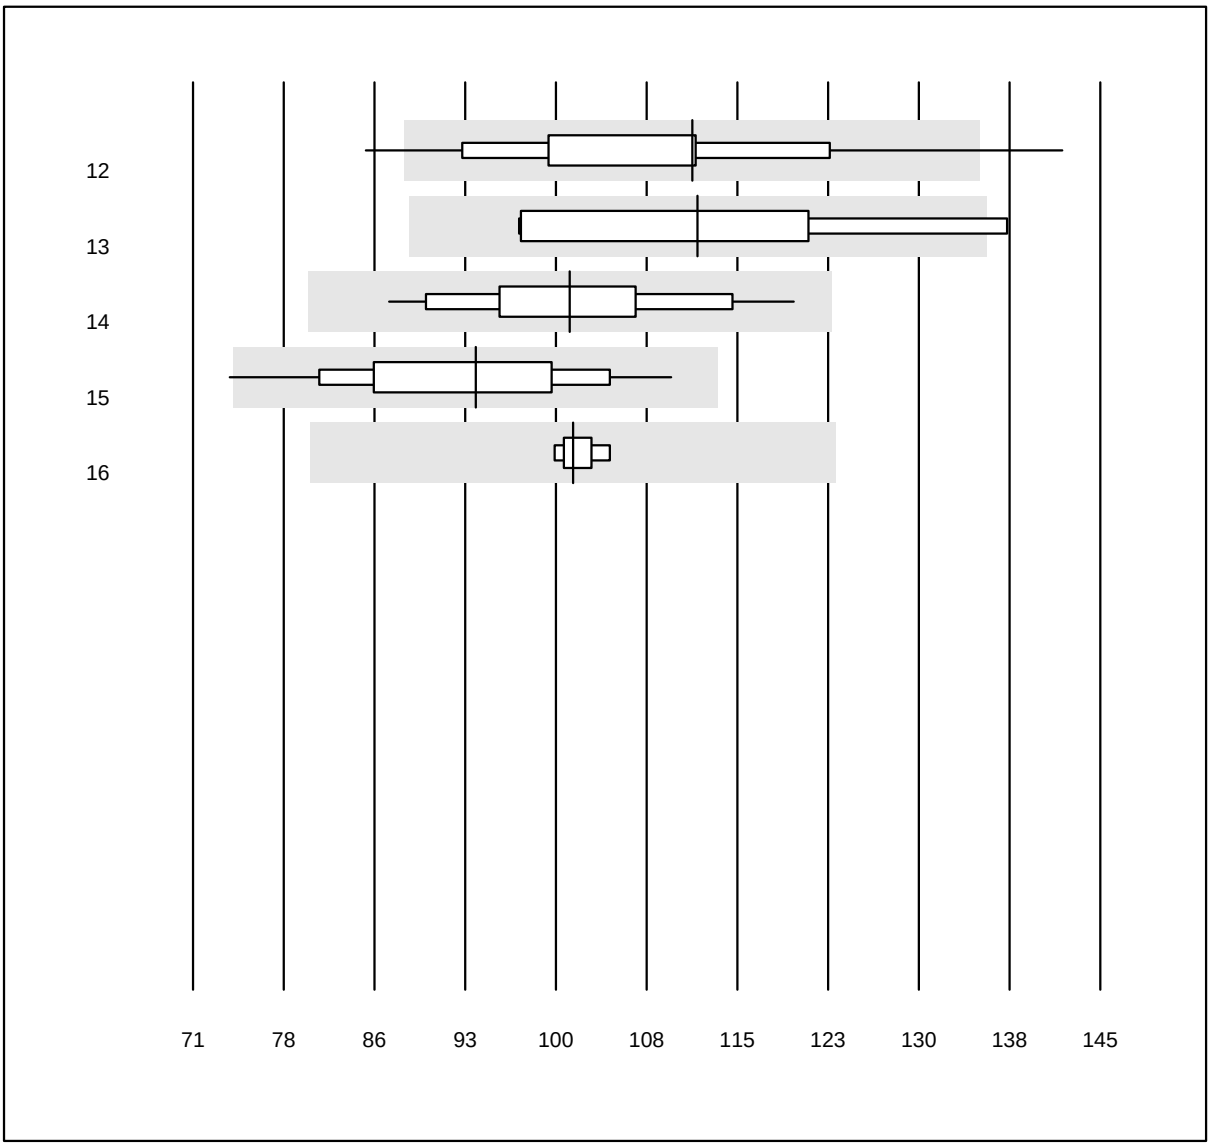


QUALAB Toleranz: 21%

CRP (mg/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
12	Eurolyser	39	71.8	7.7	20.5	111.7	11.5	e
13	Turbidimetrie	4	100.0	0.0	0.0	112.2	12.8	a*
14	Quick Read go	81	97.5	0.0	2.5	101.7	8.3	e
15	NycoCard SingleTest-Plasma	34	85.3	2.9	11.8	94.1	10.1	e
16	AQT 90 FLEX	4	100.0	0.0	0.0	102.0	1.2	e

4 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

CRP QR

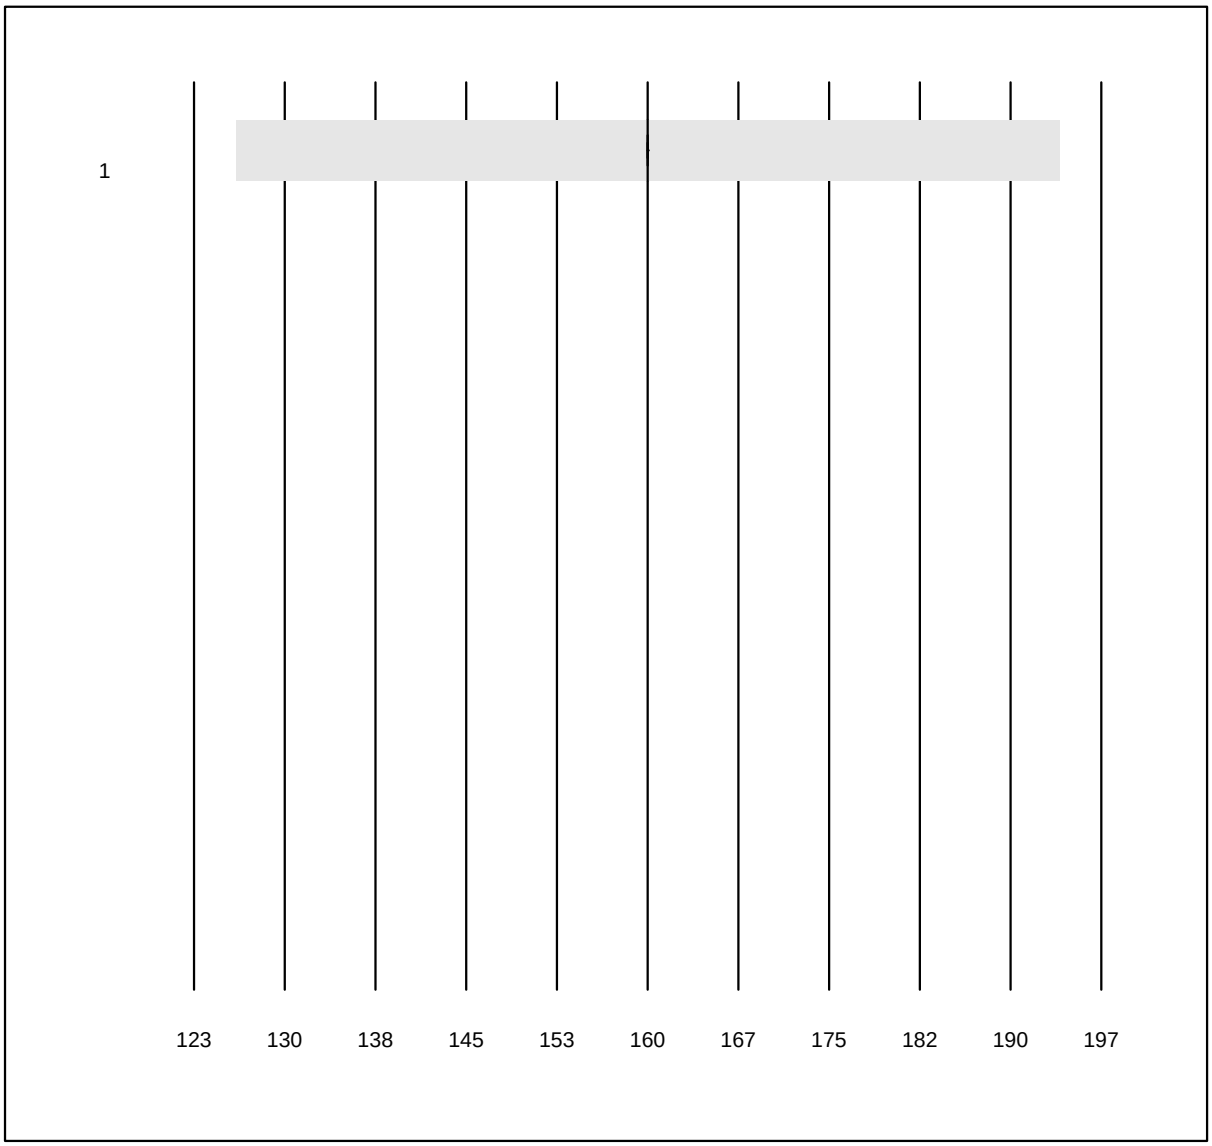


QUALAB Toleranz: 21%

CRP QR (mg/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	QuickRead (sang complet)	8	100.0	0.0	0.0	160.0	0.0	e

Alpha-1-Antitrypsine

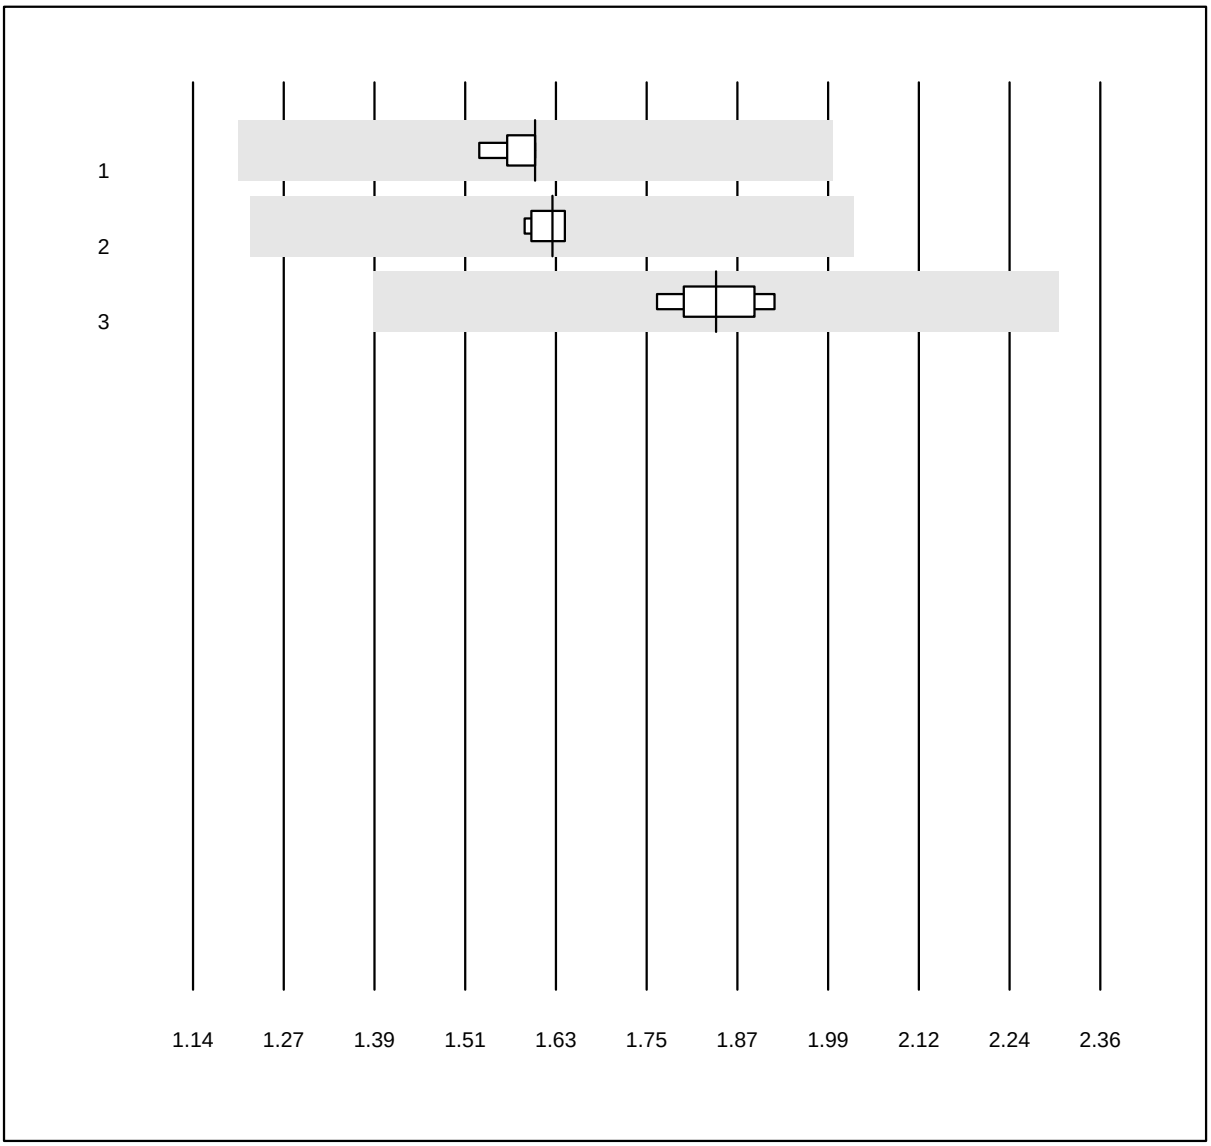


MQ Toleranz: 25%

Alpha-1-Antitrypsine (g/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	4	100.0	0.0	0.0	1.60	1.6	e
2	Roche	5	100.0	0.0	0.0	1.62	1.4	e
3	Siemens	5	100.0	0.0	0.0	1.84	2.8	e

Anti-Streptolysine-Anticorps

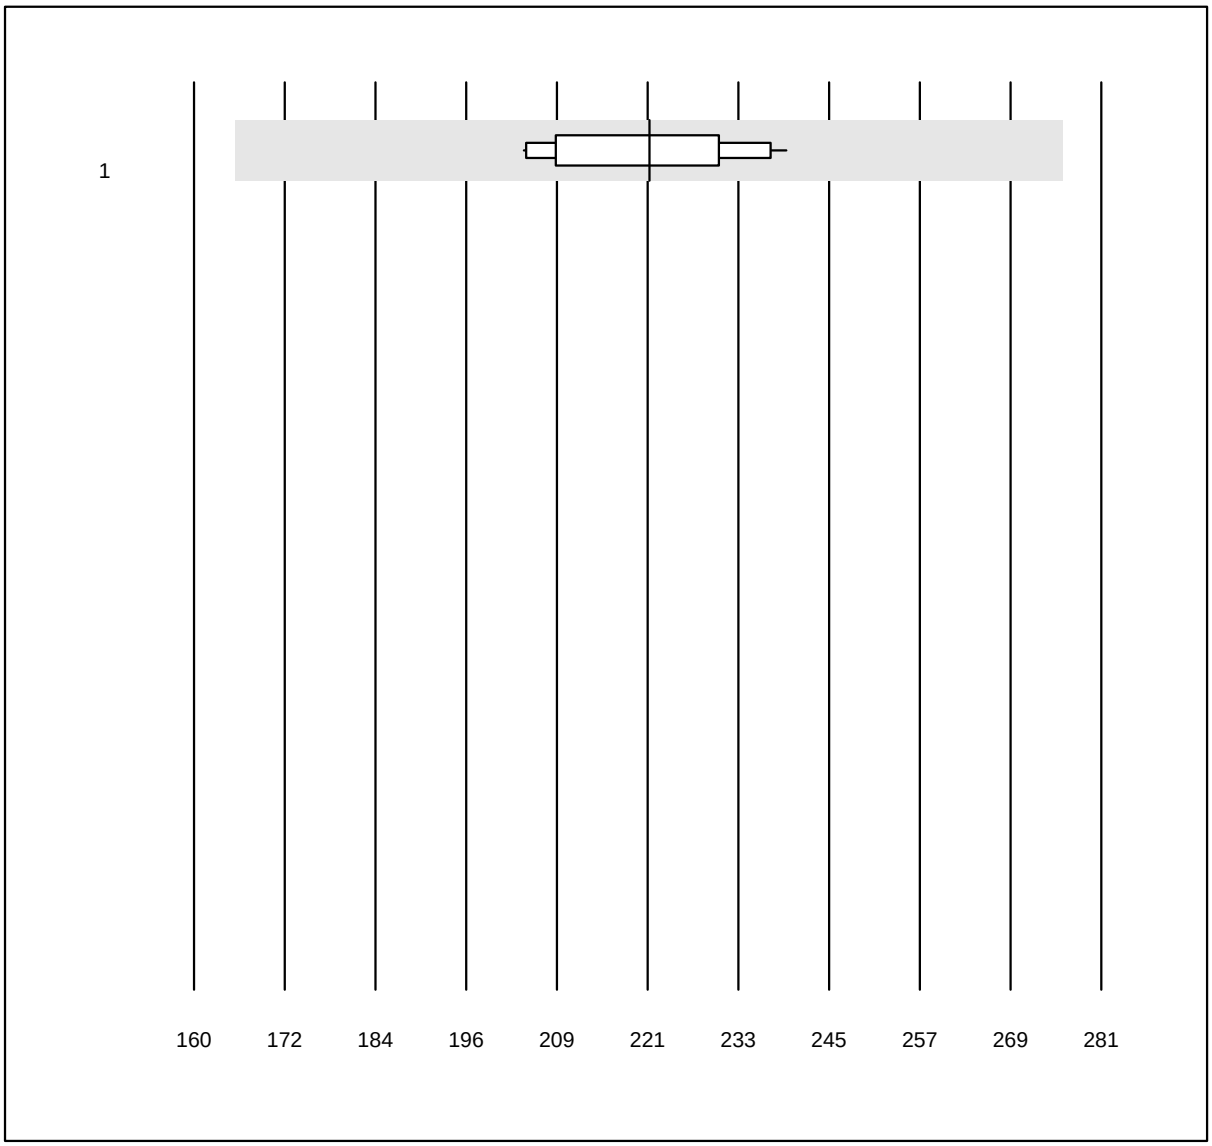


MQ Toleranz: 25%

Anti-Streptolysine-Anticorps
(kIU/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	12	100.0	0.0	0.0	221	5.2	e

3 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Bêta-2 microglobuline

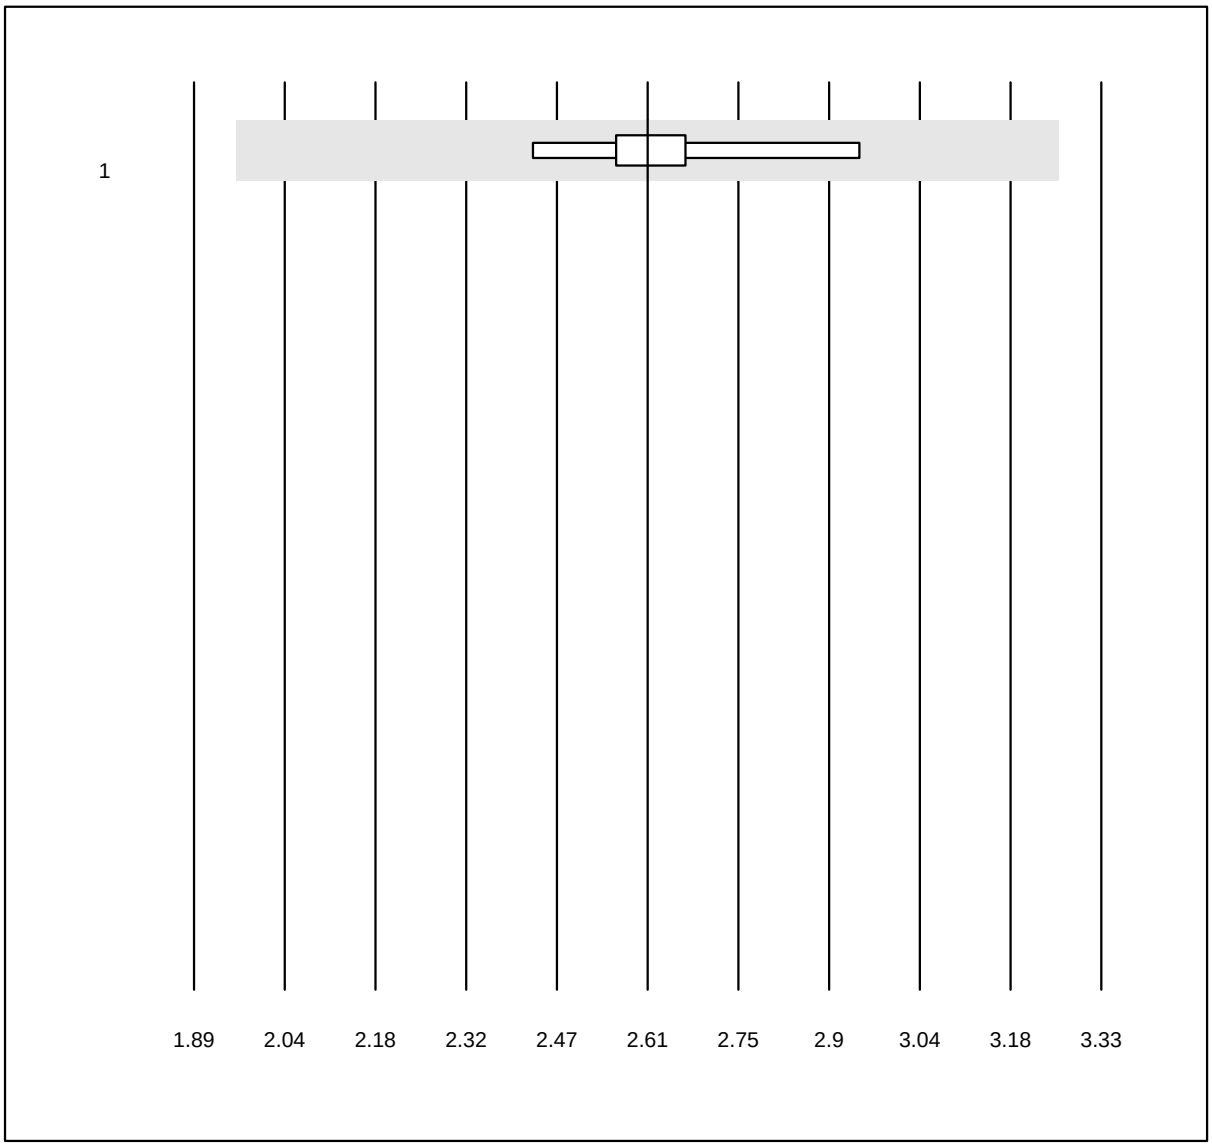


MQ Toleranz: 25%

Bêta-2 microglobuline
(mg/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	7	100.0	0.0	0.0	2.61	5.2	e

3 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Complément C3

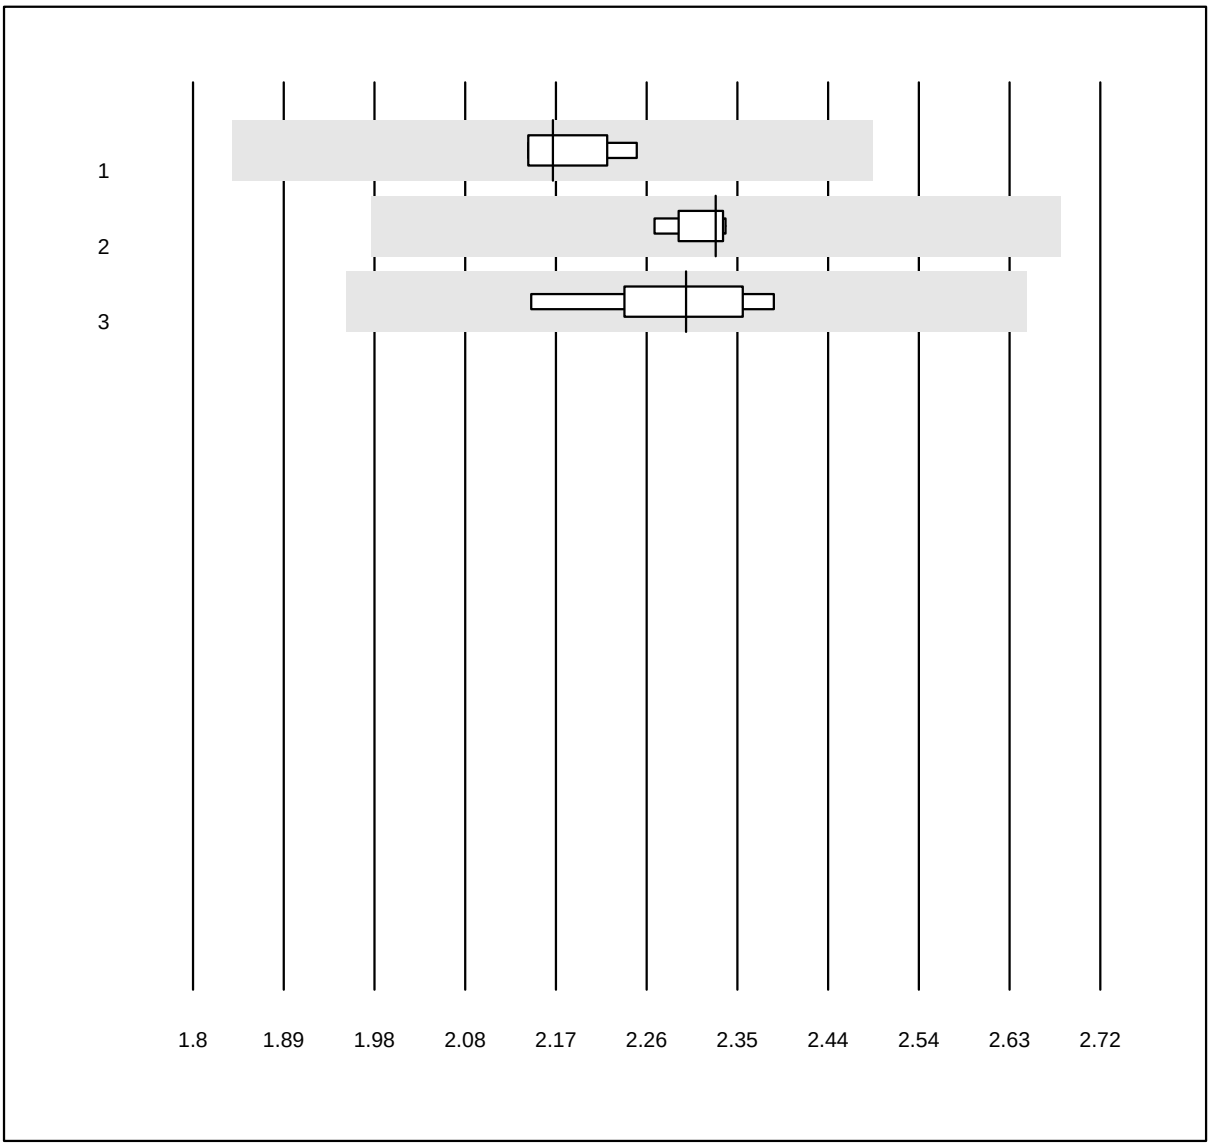


QUALAB Toleranz: 15%

Complément C3 (g/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	4	100.0	0.0	0.0	2.17	2.0	e
2	Roche	8	100.0	0.0	0.0	2.33	1.1	e
3	Siemens	6	100.0	0.0	0.0	2.30	3.3	e

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Complément C4

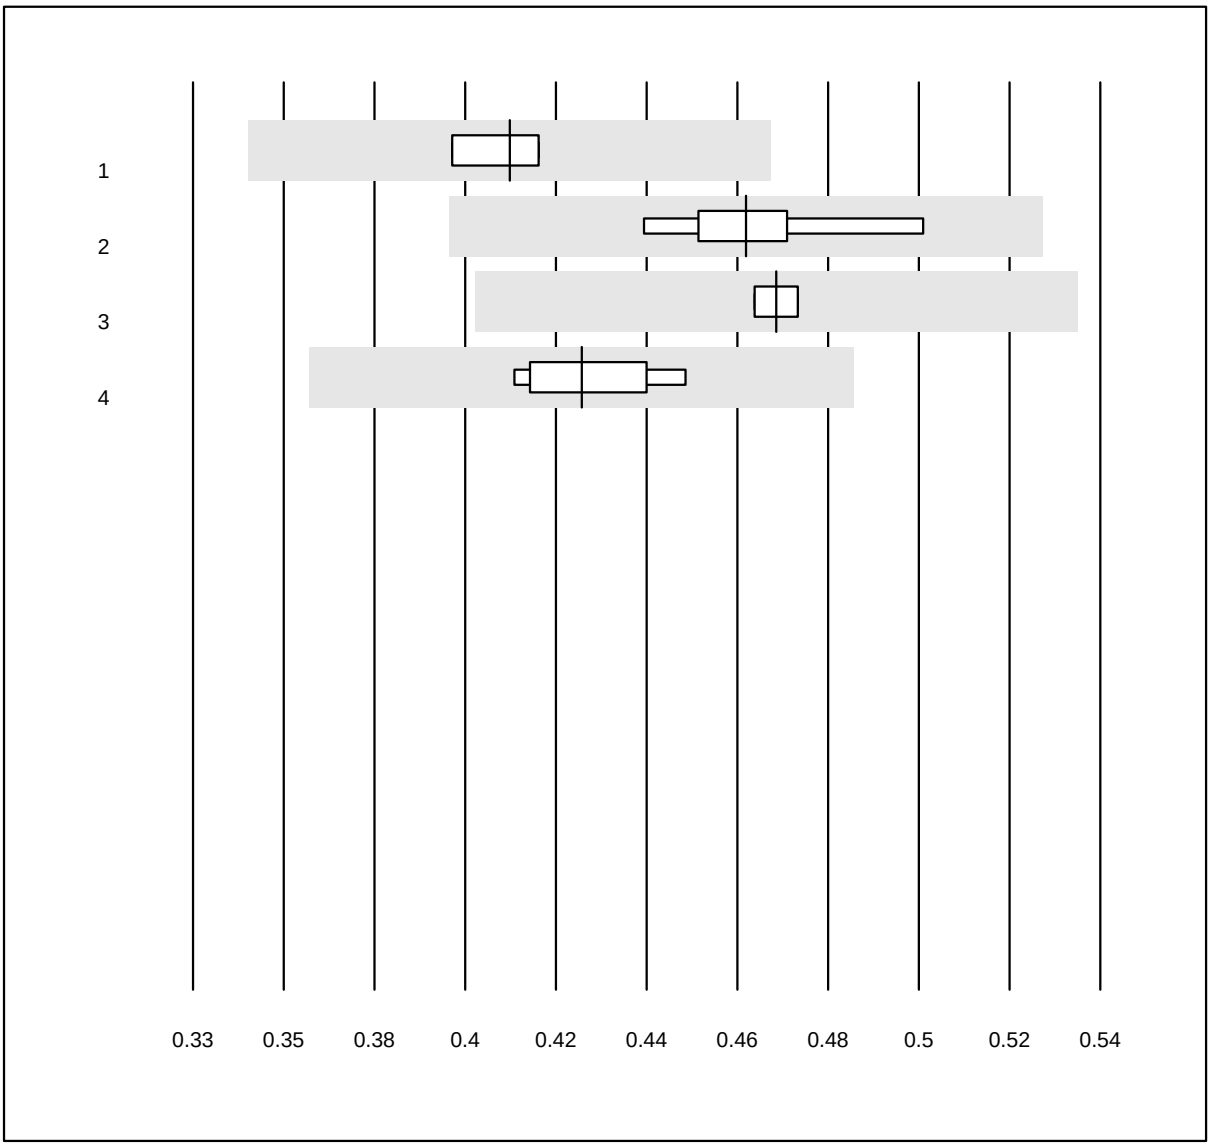


QUALAB Toleranz: 15%

Complément C4 (g/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	7	100.0	0.0	0.0	0.40	2.2	e
2	Siemens	6	100.0	0.0	0.0	0.46	3.8	e
3	Alinity	4	100.0	0.0	0.0	0.47	1.2	e
4	Autres méthodes	5	100.0	0.0	0.0	0.42	3.3	e

Céruloplasmine

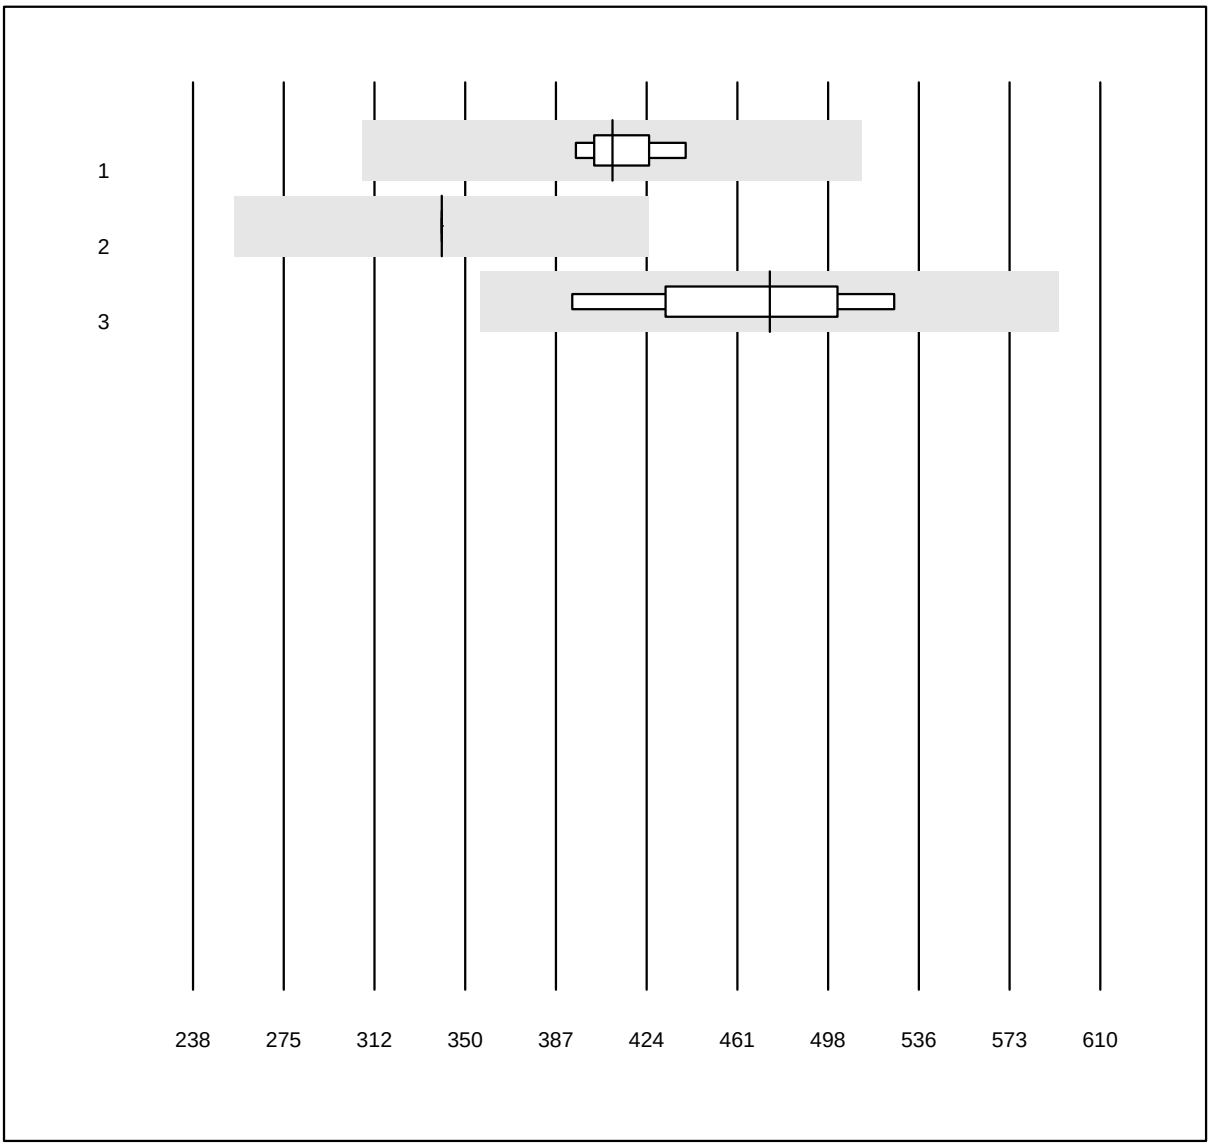


MQ Toleranz: 25%

Céruloplasmine (mg/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	4	100.0	0.0	0.0	410.00	3.1	e
2	Roche	5	100.0	0.0	0.0	340.00	0.0	e
3	Siemens	4	100.0	0.0	0.0	474.50	8.0	e*

chaînes légères libres Kappa

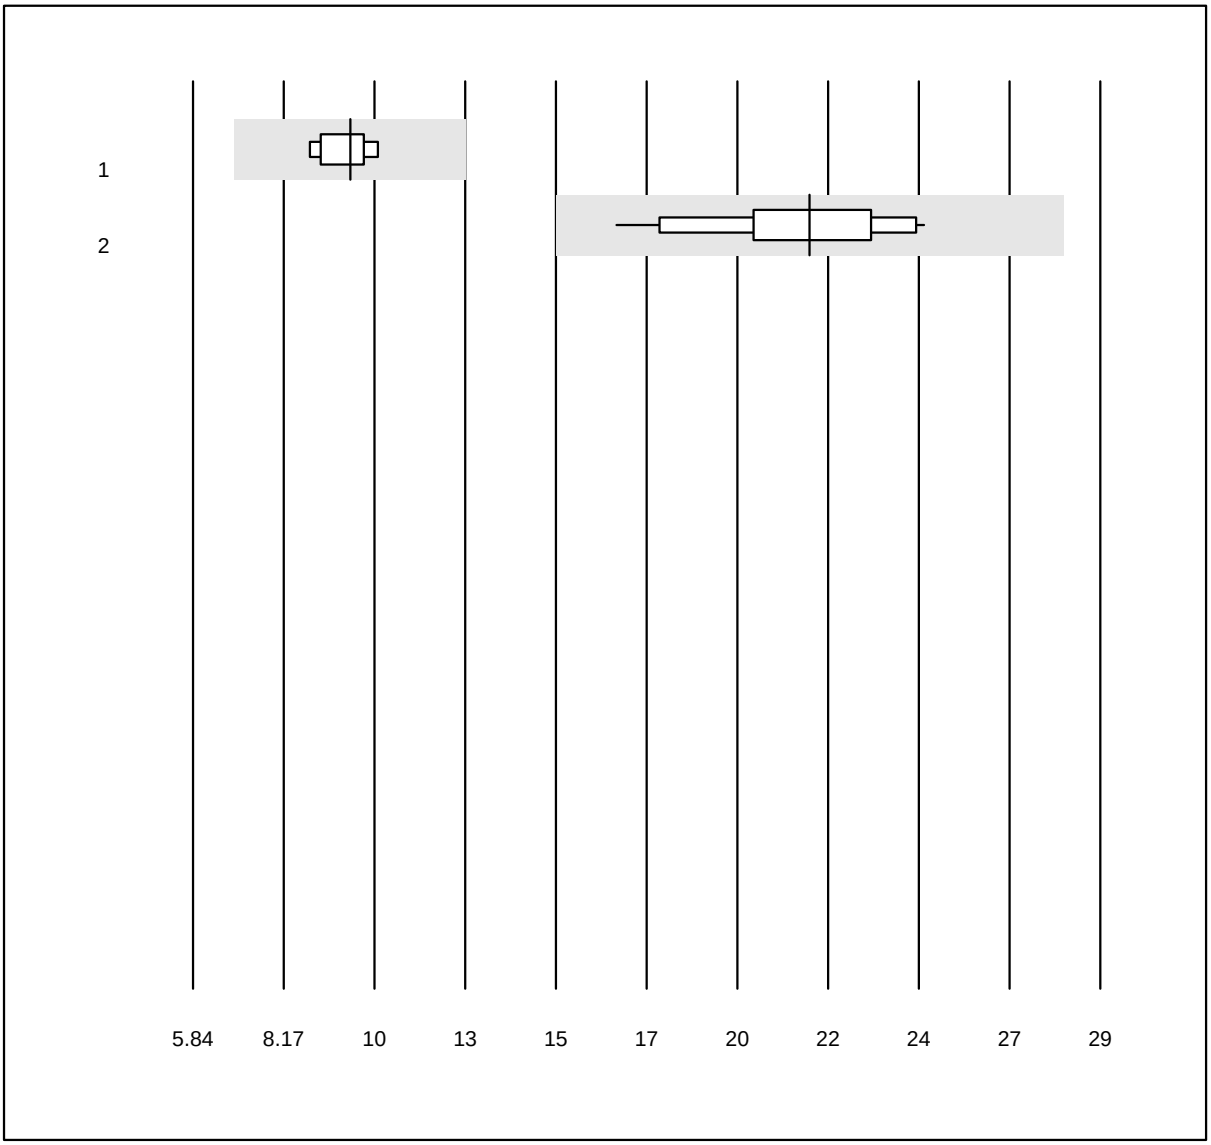


QUALAB Toleranz: 30%

chaînes légères libres
Kappa (mg/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	N Latex	7	100.0	0.0	0.0	9.86	6.2	e
2	Freelite	13	100.0	0.0	0.0	21.58	10.0	e

chaîne légère Lambda

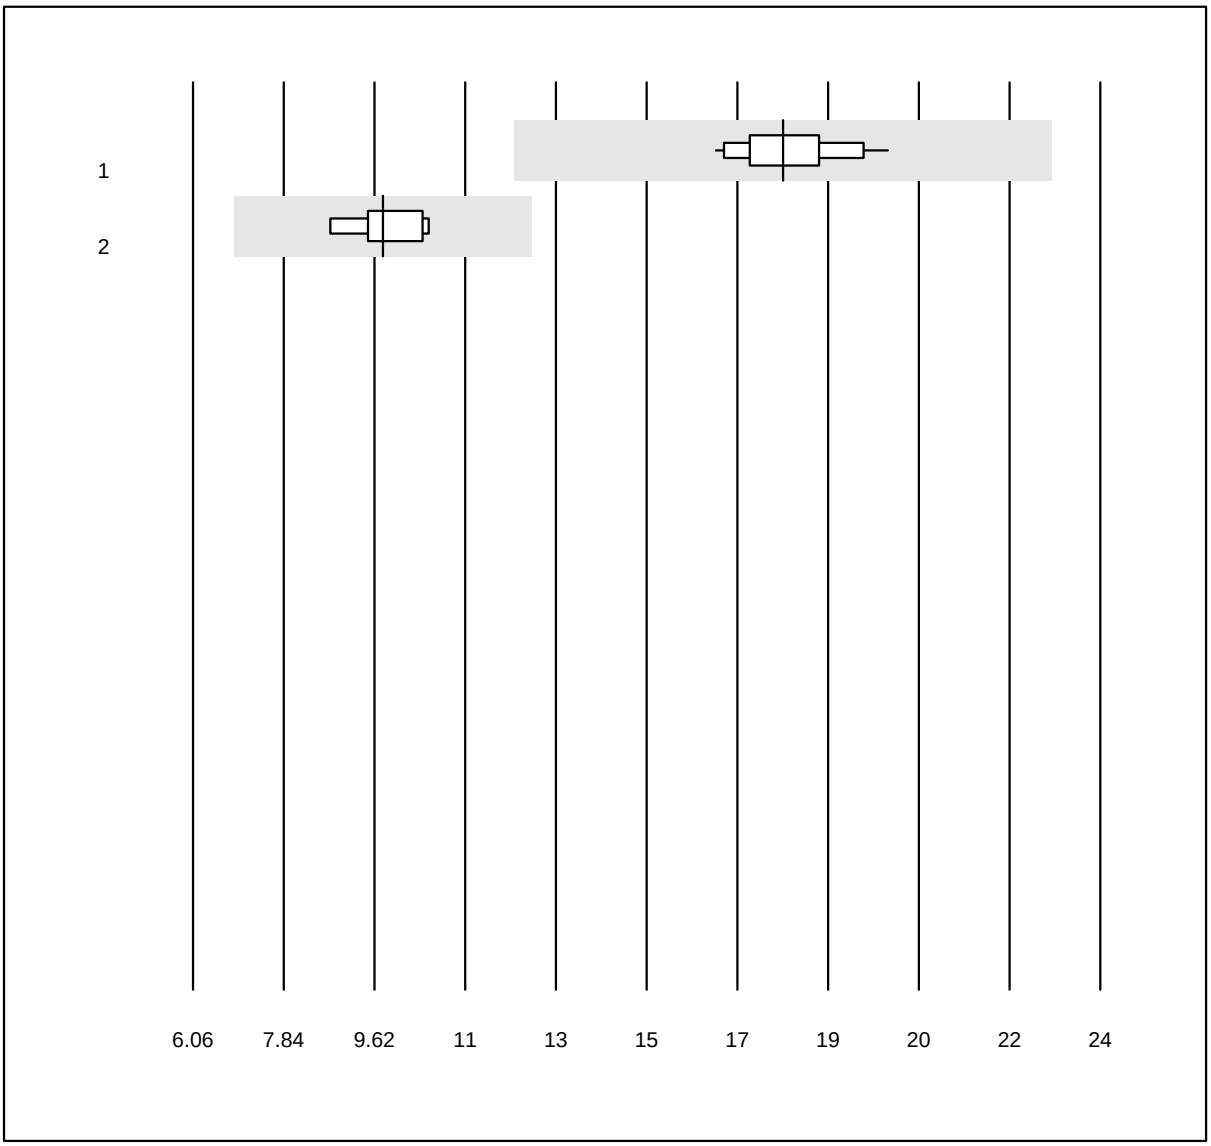


QUALAB Toleranz: 30%

chaîne légère Lambda
(mg/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Freelite	13	100.0	0.0	0.0	17.73	5.3	e
2	N Latex	7	100.0	0.0	0.0	9.82	6.4	e

Haptoglobine

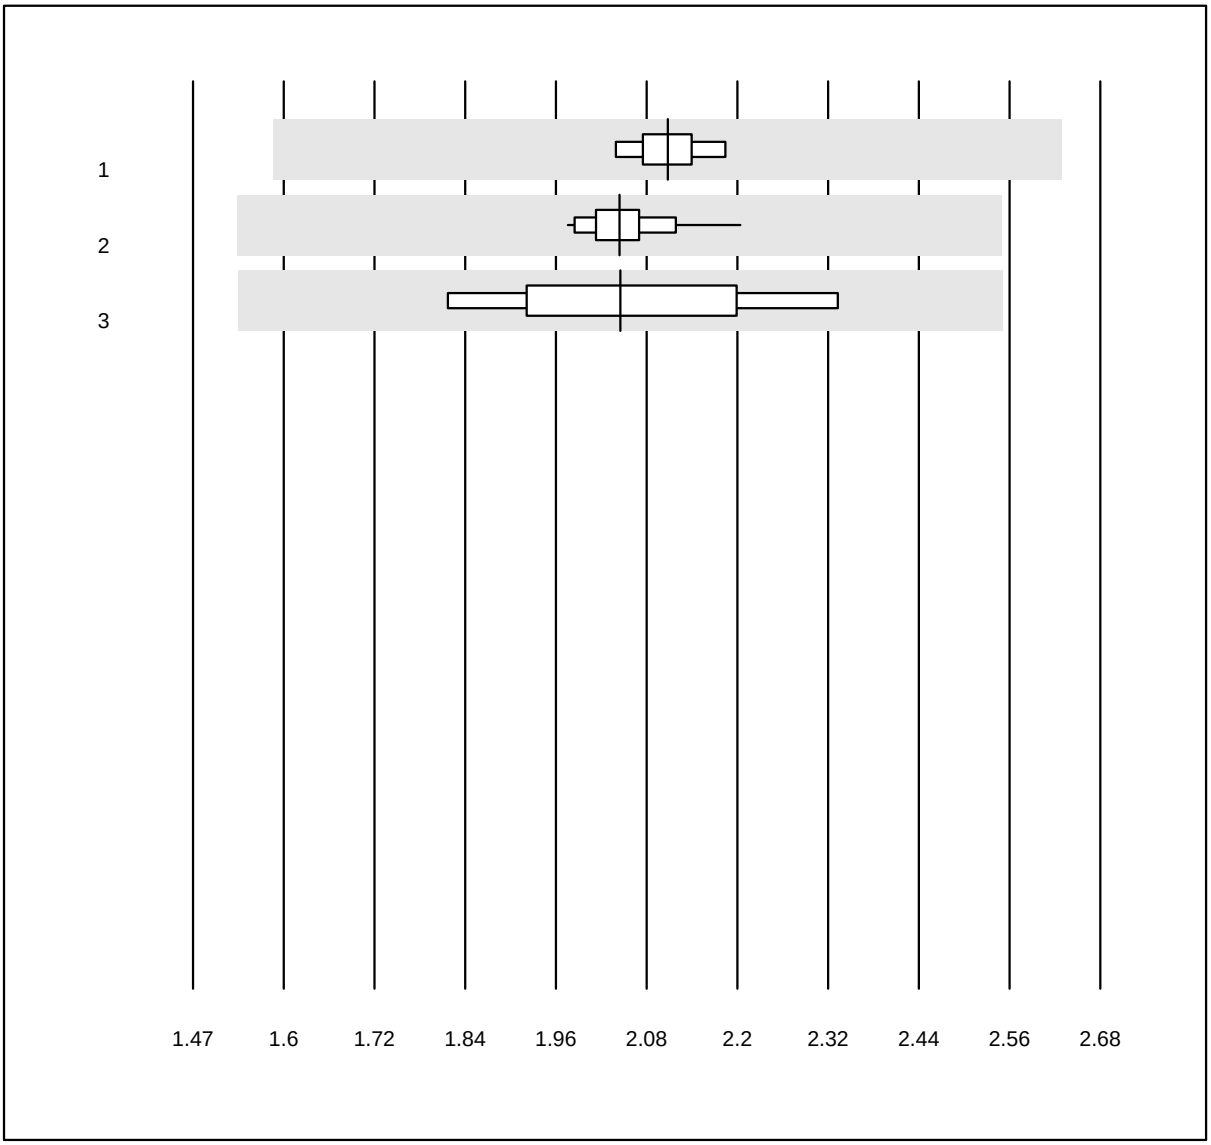


MQ Toleranz: 25%

Haptoglobine (g/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	5	100.0	0.0	0.0	2.10	1.9	e
2	Roche	22	100.0	0.0	0.0	2.04	2.5	e
3	Siemens	4	100.0	0.0	0.0	2.04	7.2	e*

IgA

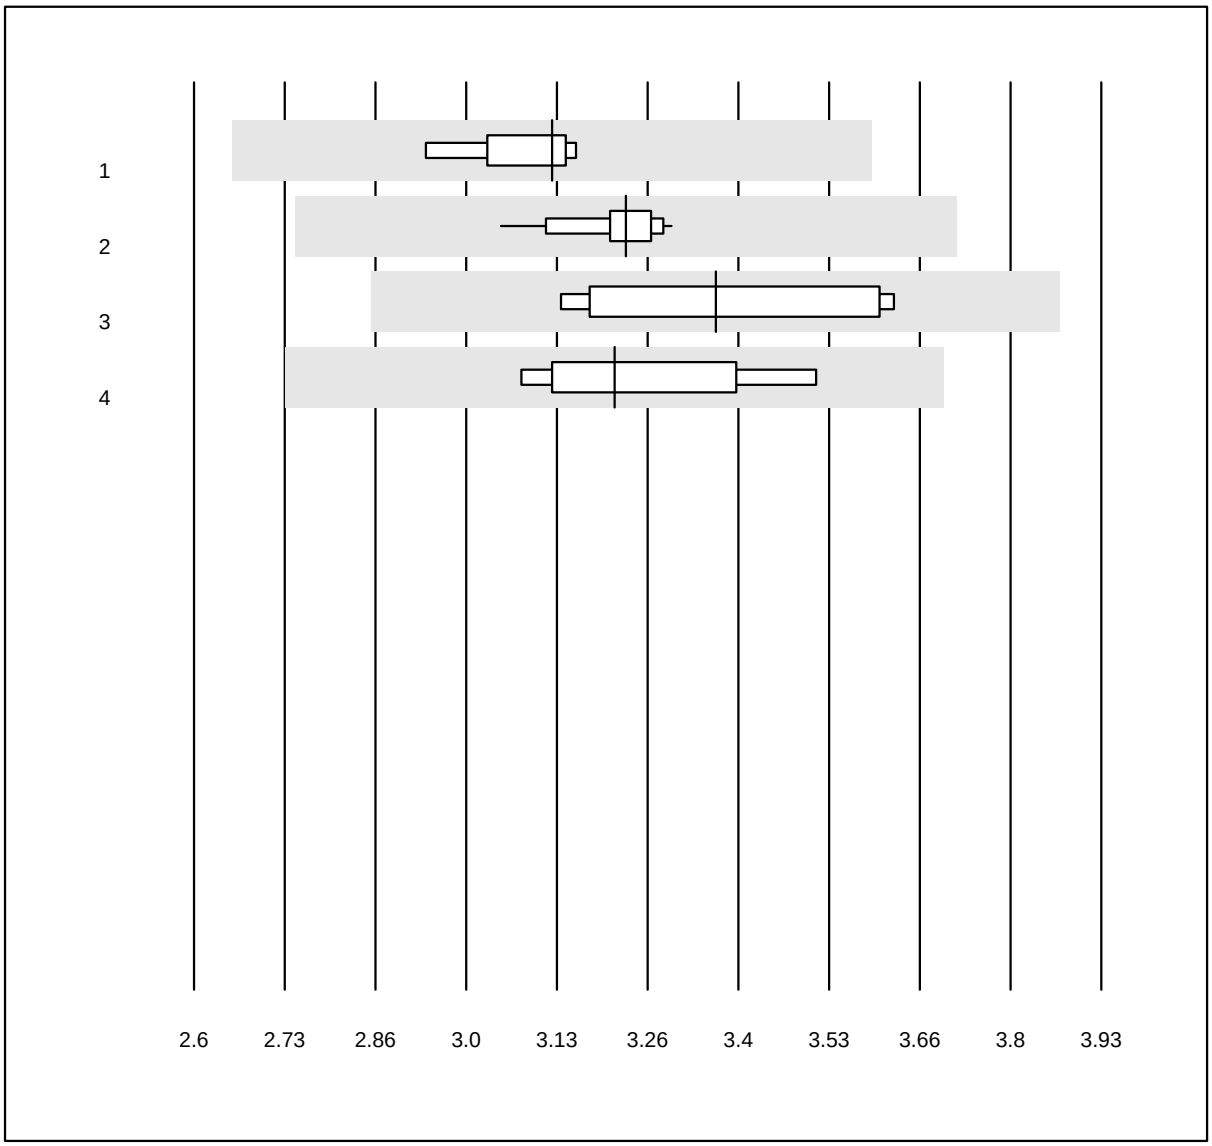


QUALAB Toleranz: 15%

IgA (g/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	4	100.0	0.0	0.0	3.13	2.2	e
2	Roche	15	100.0	0.0	0.0	3.23	1.9	e
3	Siemens	6	100.0	0.0	0.0	3.37	5.8	e*
4	Autres méthodes	5	100.0	0.0	0.0	3.22	4.6	e*

IgE

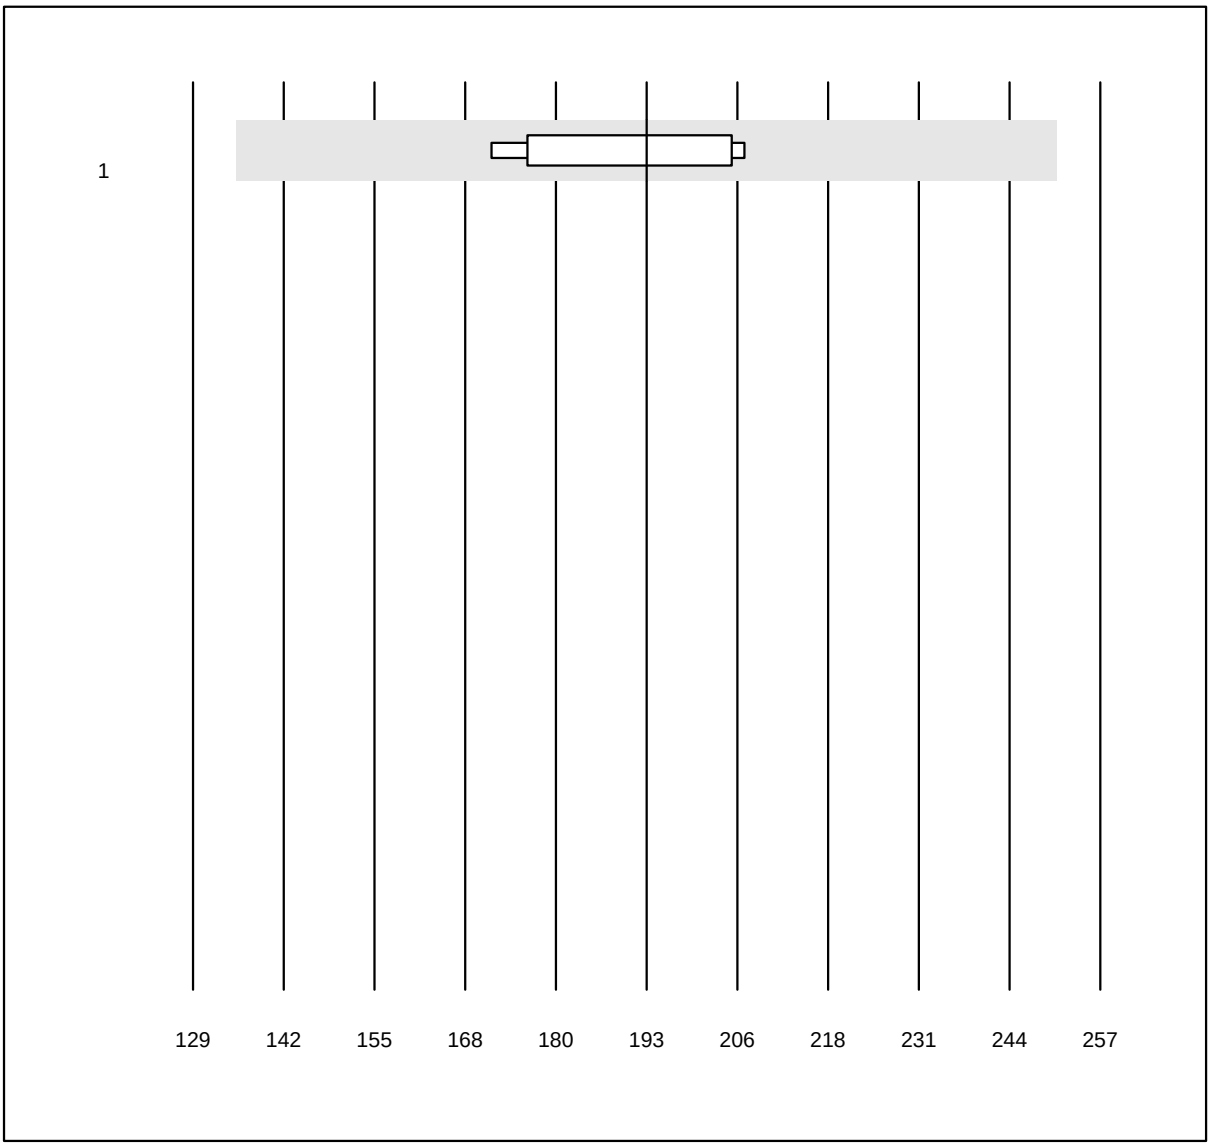


QUALAB Toleranz: 30%

IgE (kU/L)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	5	100.0	0.0	0.0	193	7.7	e

3 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

IgG

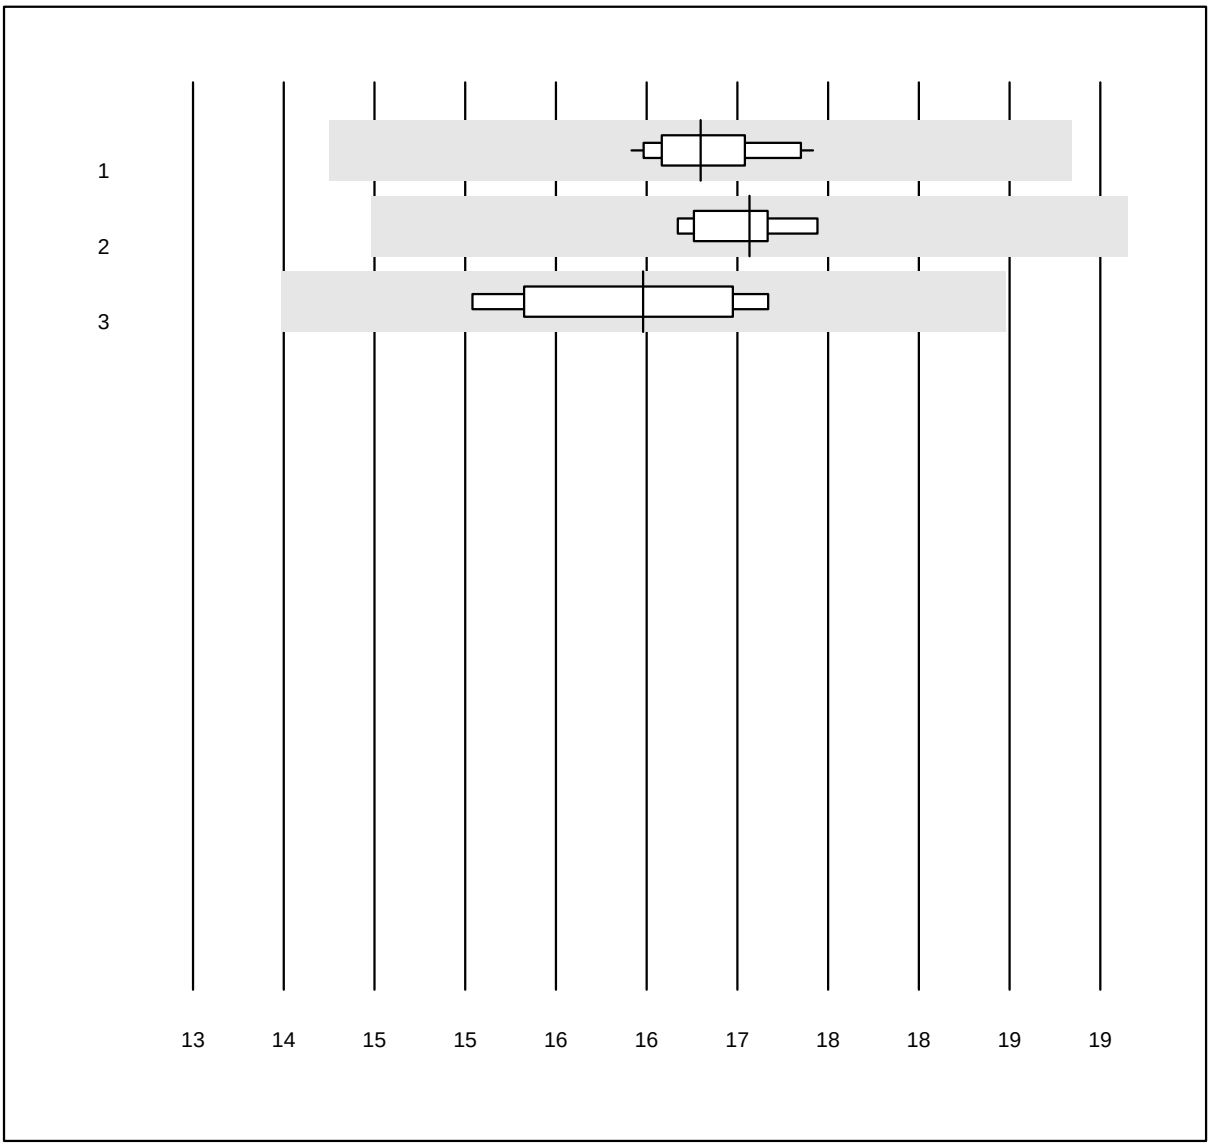


QUALAB Toleranz: 15%

IgG (g/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	17	100.0	0.0	0.0	16.36	2.1	e
2	Siemens	8	100.0	0.0	0.0	16.68	1.8	e
3	Autres méthodes	5	100.0	0.0	0.0	15.98	4.5	e*

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

IgM

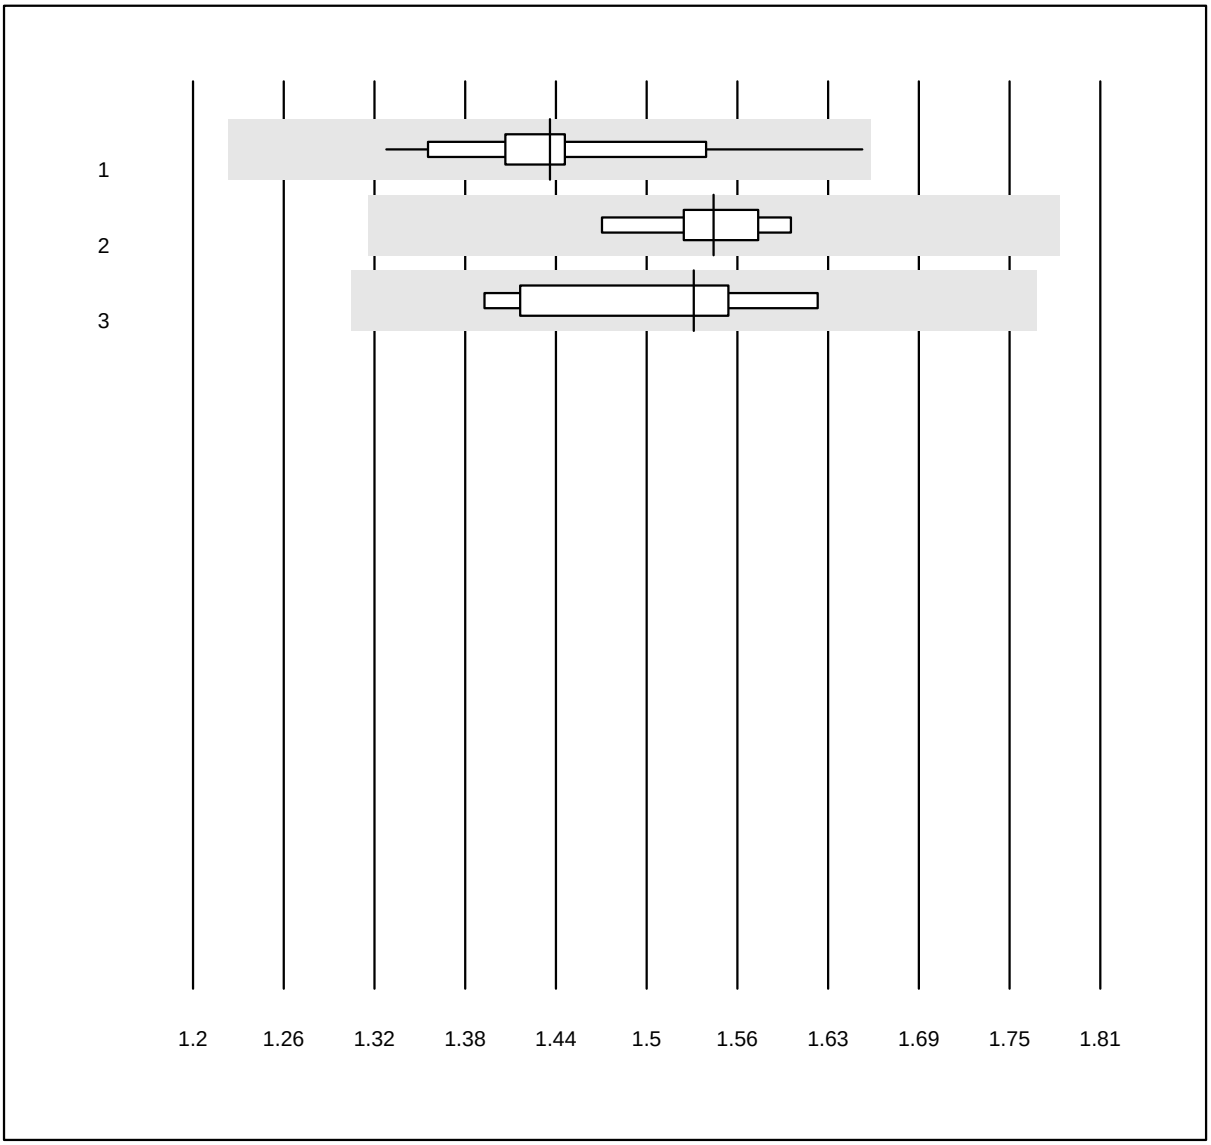


QUALAB Toleranz: 15%

IgM (g/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	16	100.0	0.0	0.0	1.44	4.8	a
2	Siemens	8	100.0	0.0	0.0	1.55	2.5	e
3	Turbidimetrie	7	100.0	0.0	0.0	1.54	5.2	e*

Récepteur soluble de la transferrine

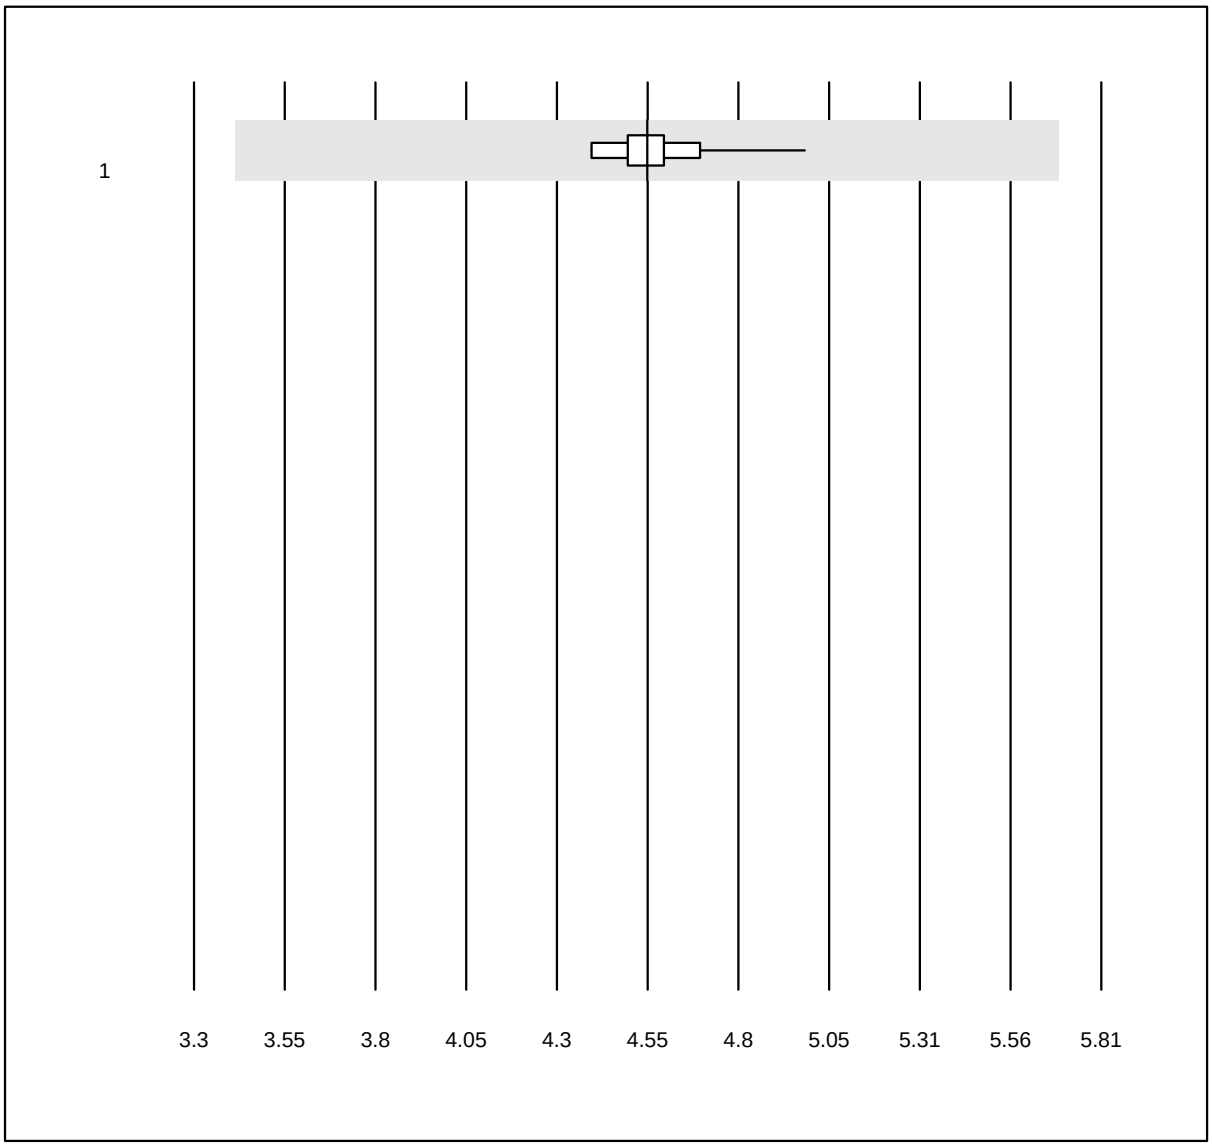


MQ Toleranz: 25%

Récepteur soluble de la transferrine (mg/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	19	100.0	0.0	0.0	4.6	2.8	e

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Pré-albumine

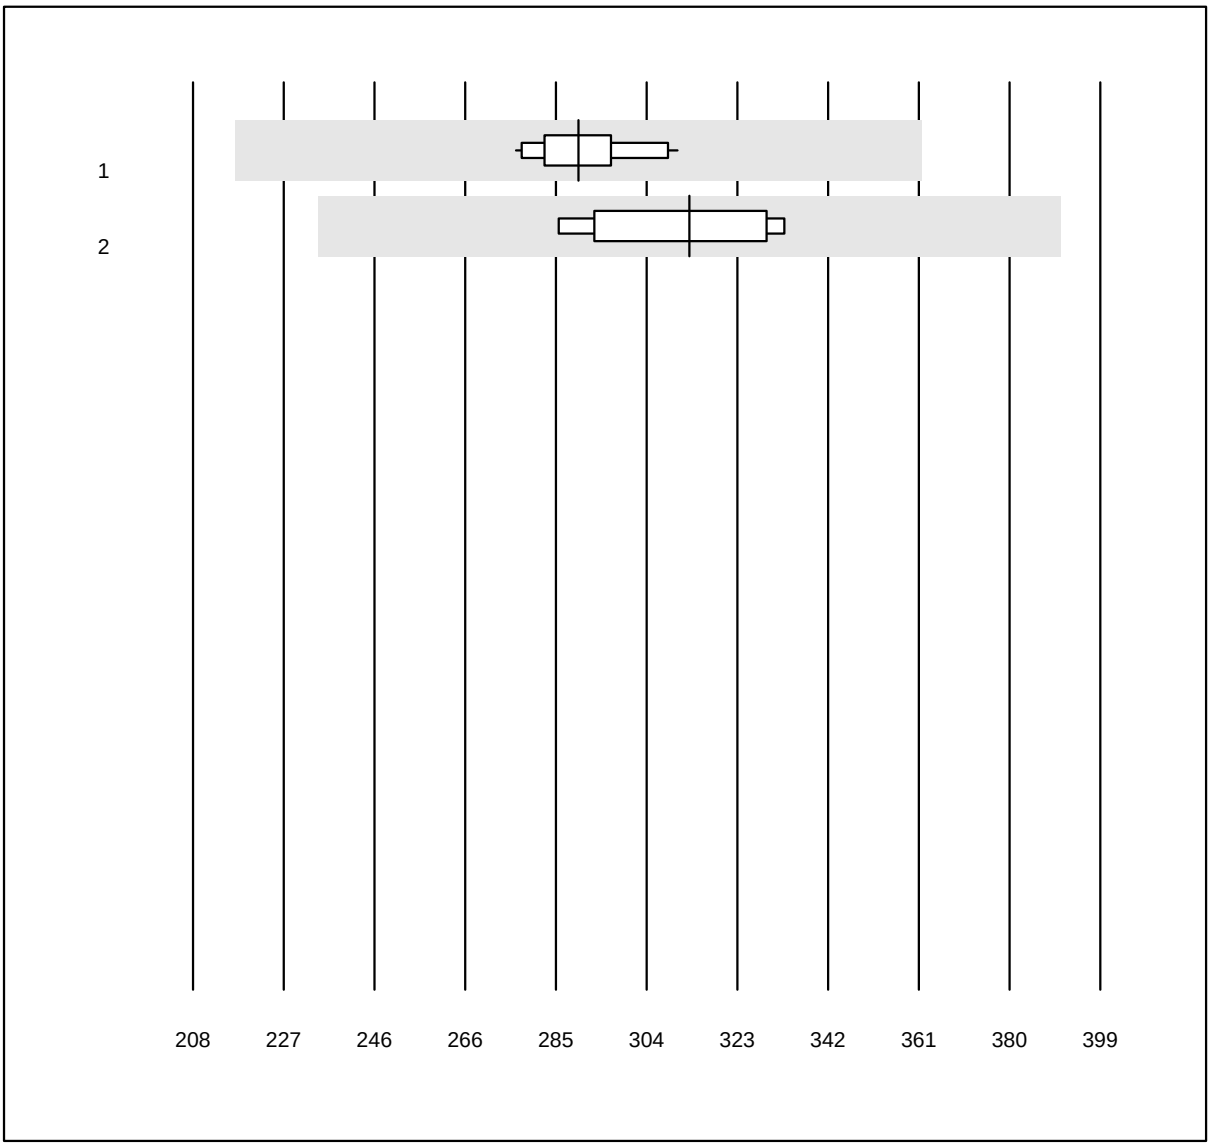


MQ Toleranz: 25%

Pré-albumine (mg/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	11	100.0	0.0	0.0	289.16	3.4	e
2	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	312.50	6.2	e*

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Facteur rhumatoïde

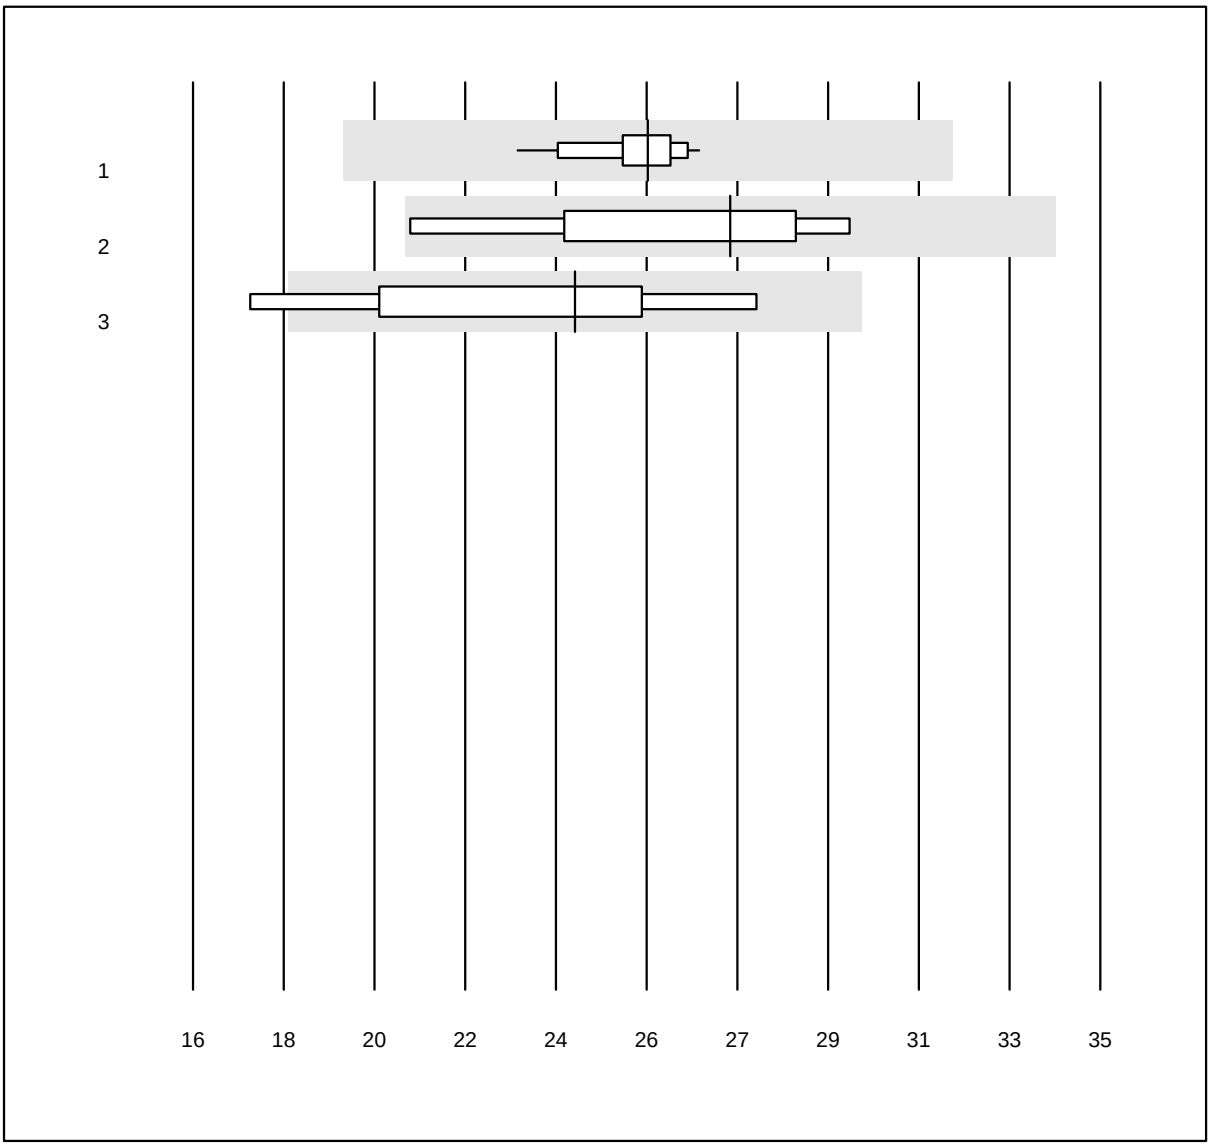


MQ Toleranz: 25%

Facteur rhumatoïde (U/ml)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	15	100.0	0.0	0.0	25.5	3.7	e
2	Siemens	4	100.0	0.0	0.0	27.3	10.2	e*
3	Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	24.0	13.0	a*

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Transferrine

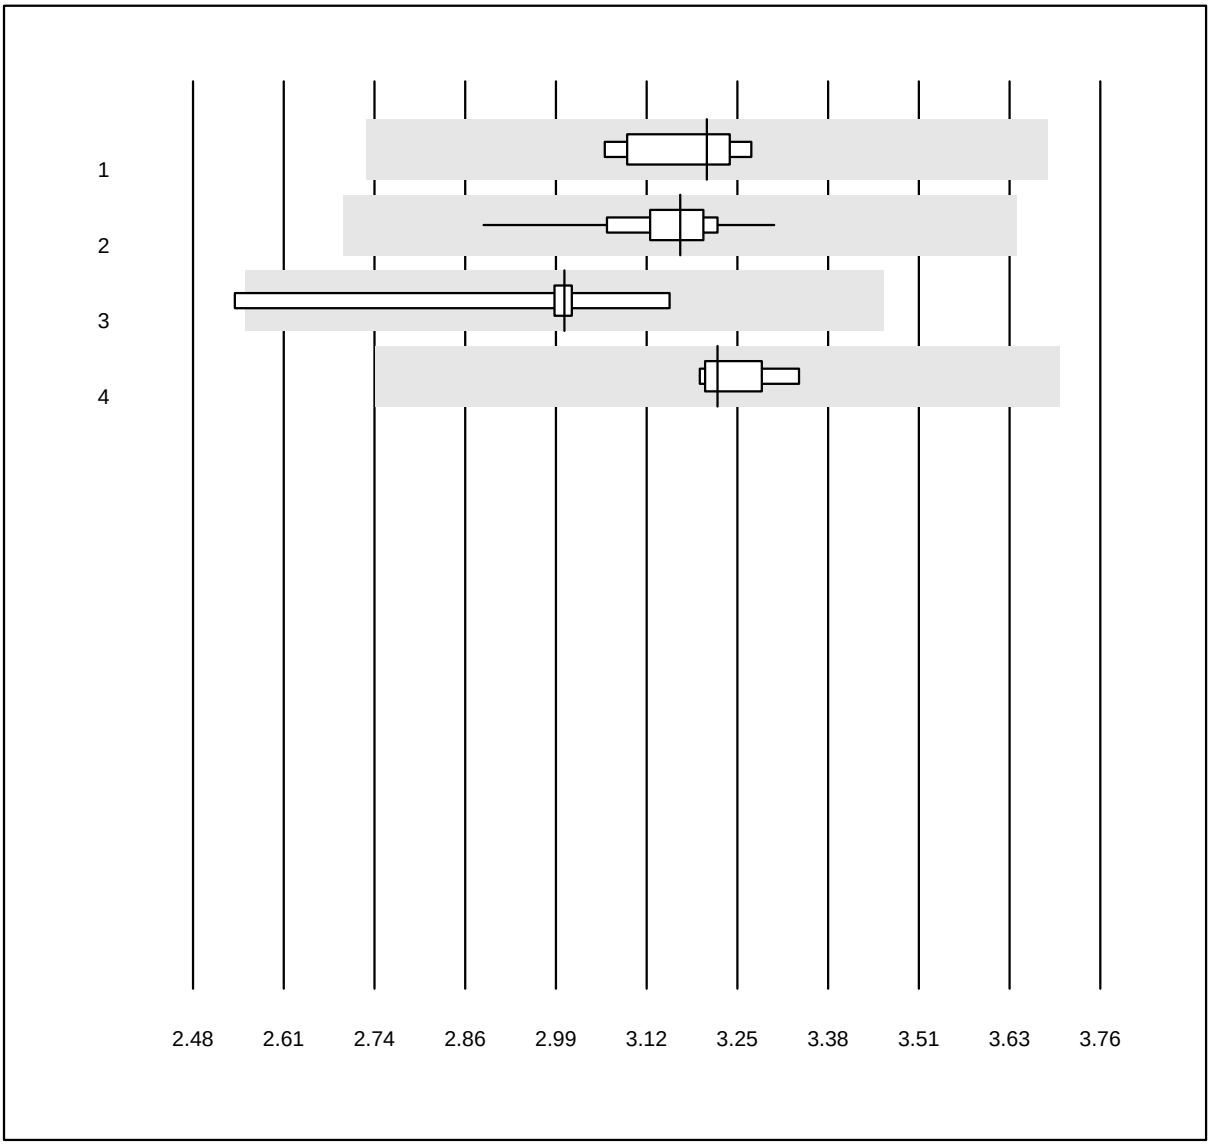


QUALAB Toleranz: 15%

Transferrine (g/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	6	100.0	0.0	0.0	3.21	2.4	e
2	Roche	29	100.0	0.0	0.0	3.17	2.5	e
3	Siemens	8	100.0	0.0	0.0	3.00	5.5	e*
4	Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	3.22	1.4	e

IgE bouleau qn

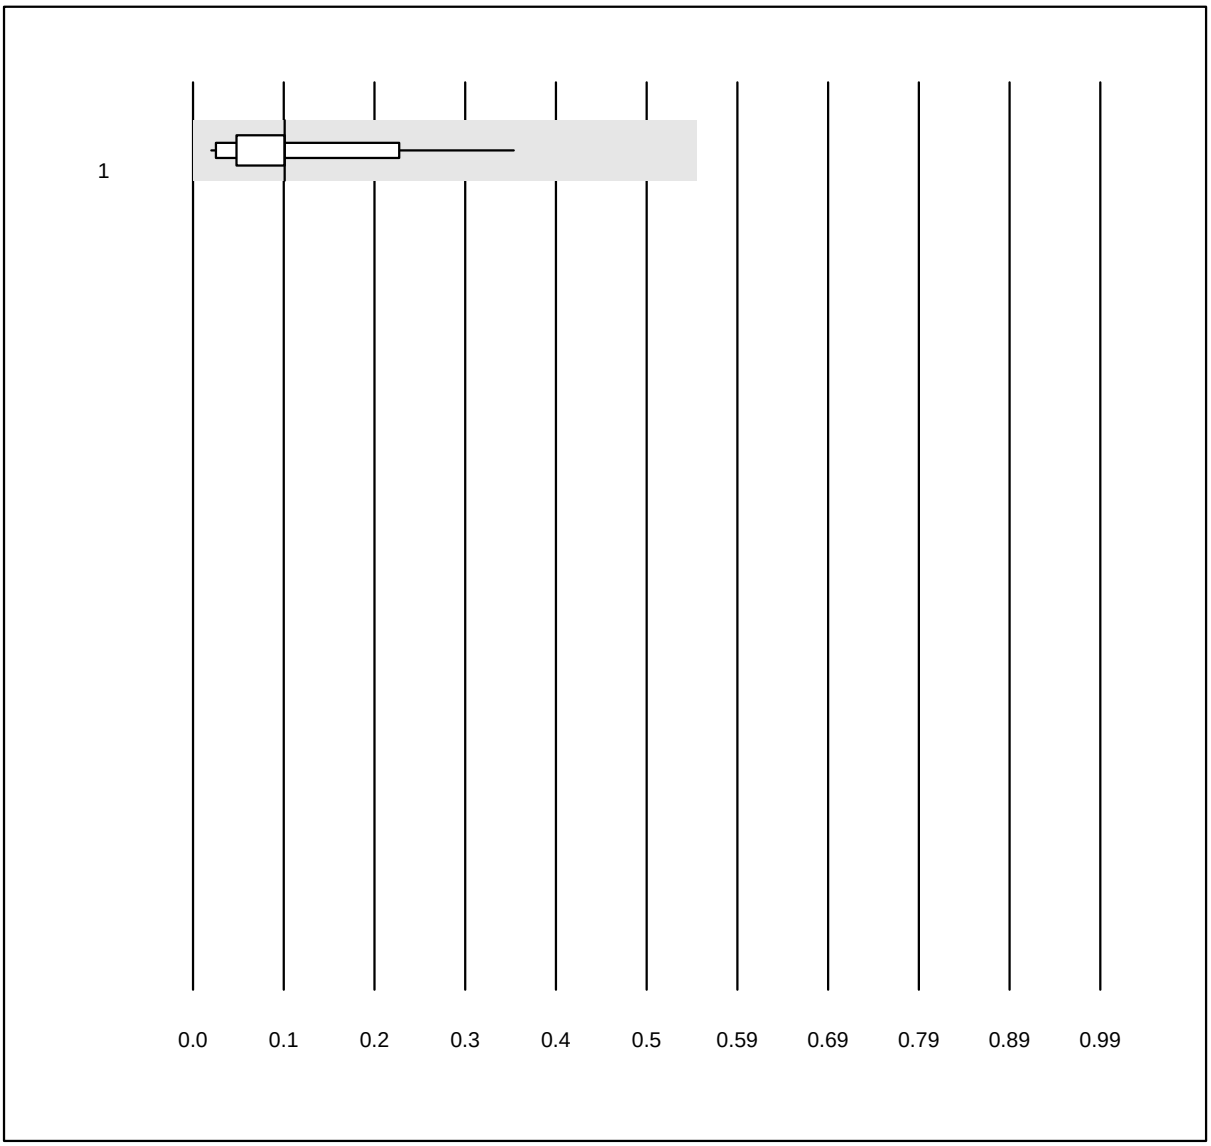


QUALAB Toleranz: 30%
(< 1.5: +/- 0.45 kU/L)

IgE bouleau qn (kU/L)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	toutes les méthodes	14	100.0	0.0	0.0	0.10	79.0	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

IgE D. pteronyssinus qn

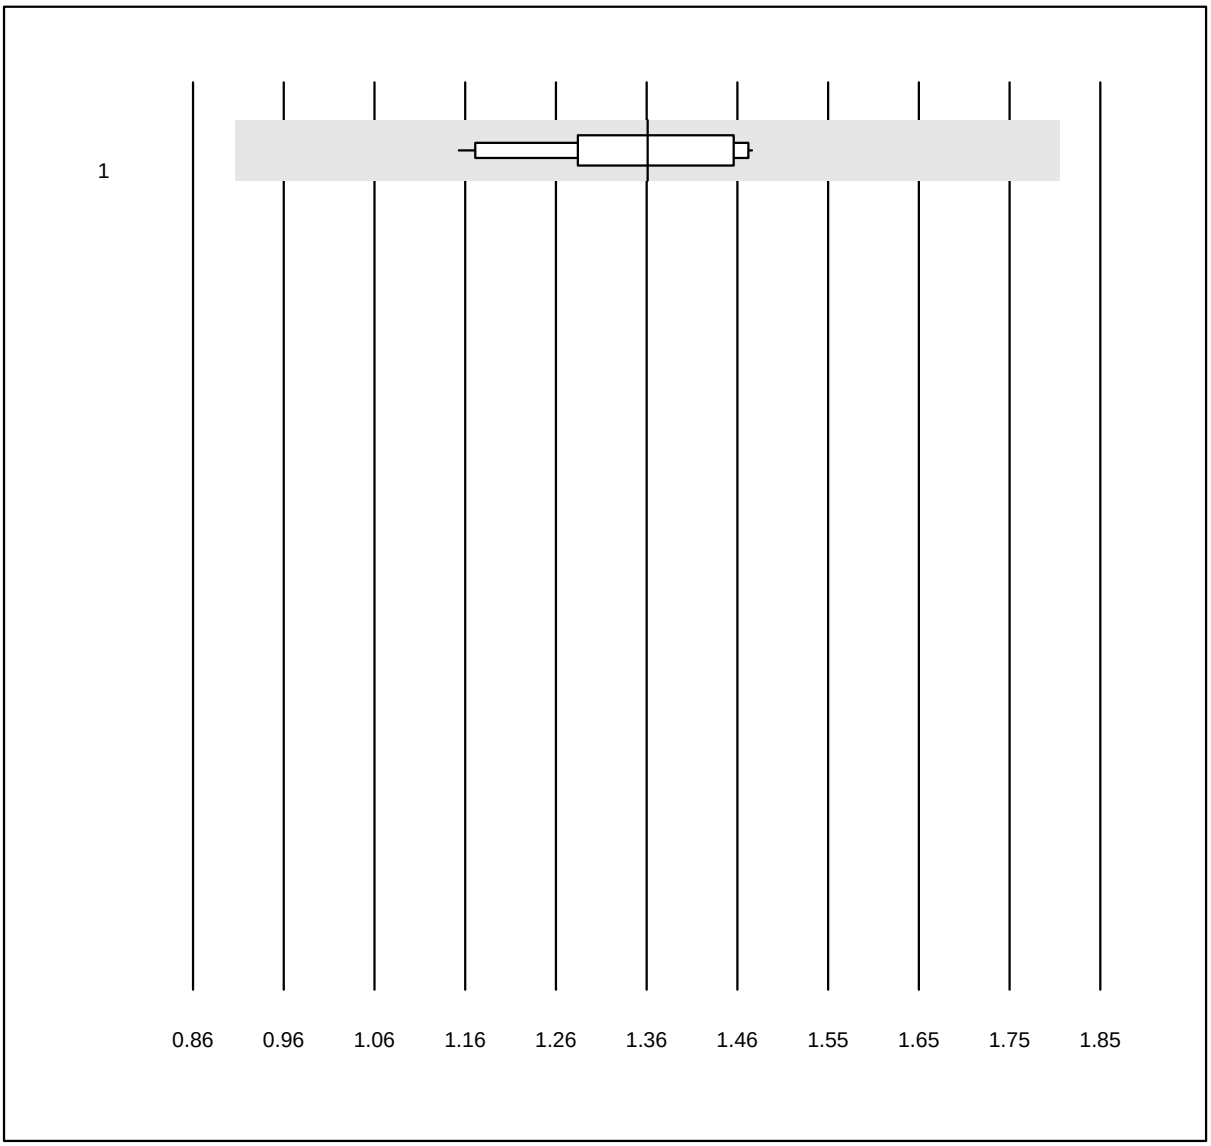


QUALAB Toleranz: 30%
(< 1.5: +/- 0.45 kU/L)

IgE D. pteronyssinus qn
(kU/L)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	toutes les méthodes	11	100.0	0.0	0.0	1.36	7.6	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

IgE arachides qn

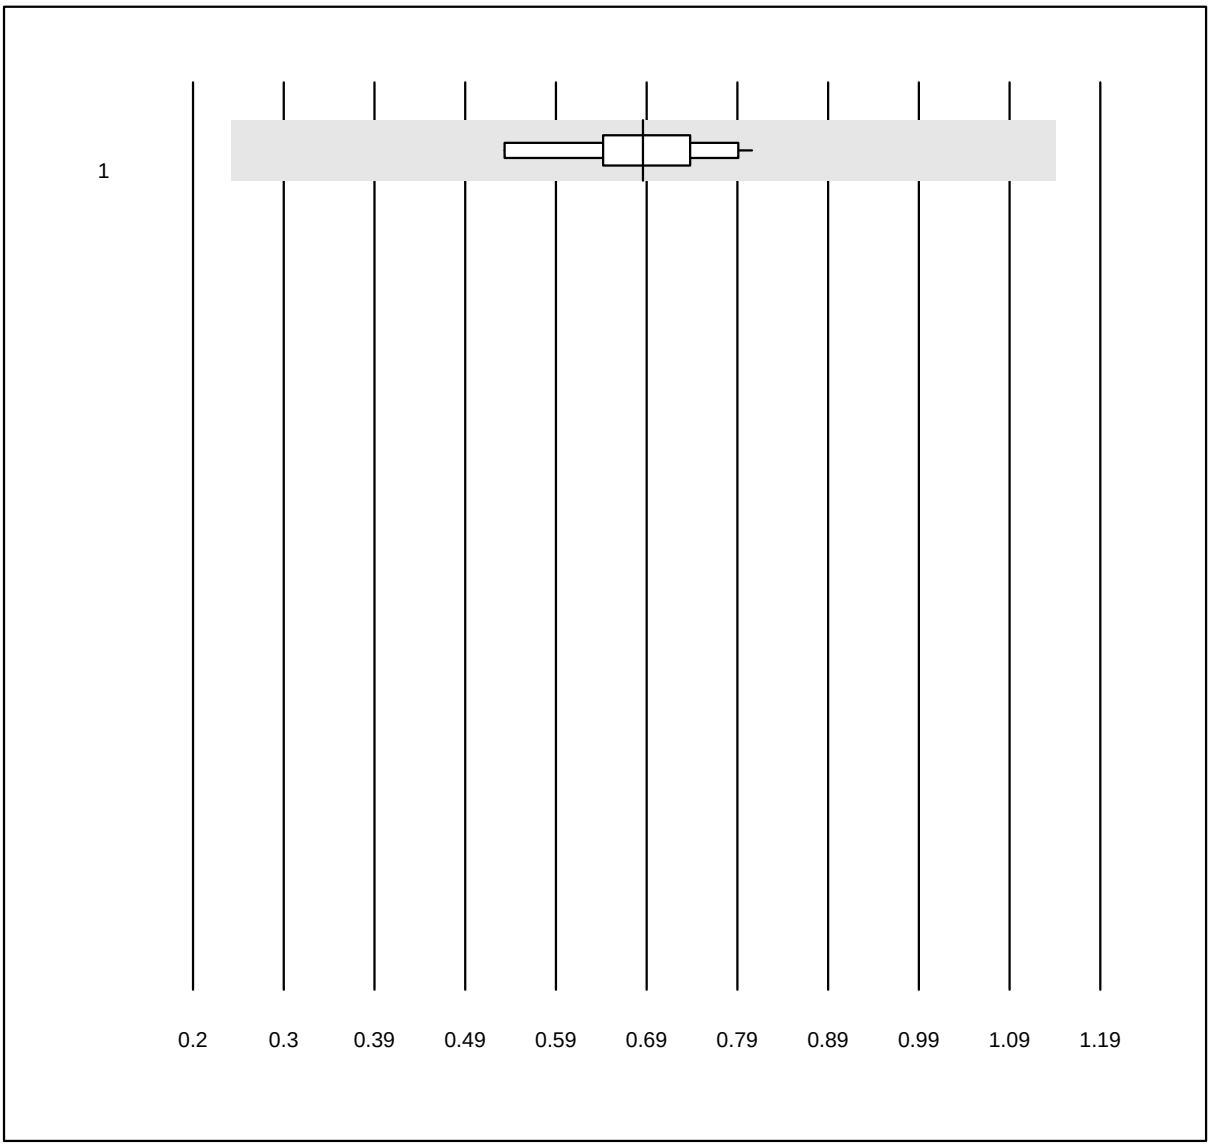


MQ Toleranz: 30%
(< 1.5: +/- 0.45 kU/L)

IgE arachides qn (kU/L)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	toutes les méthodes	12	100.0	0.0	0.0	0.69	11.8	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

IgE épithélium du chat qn

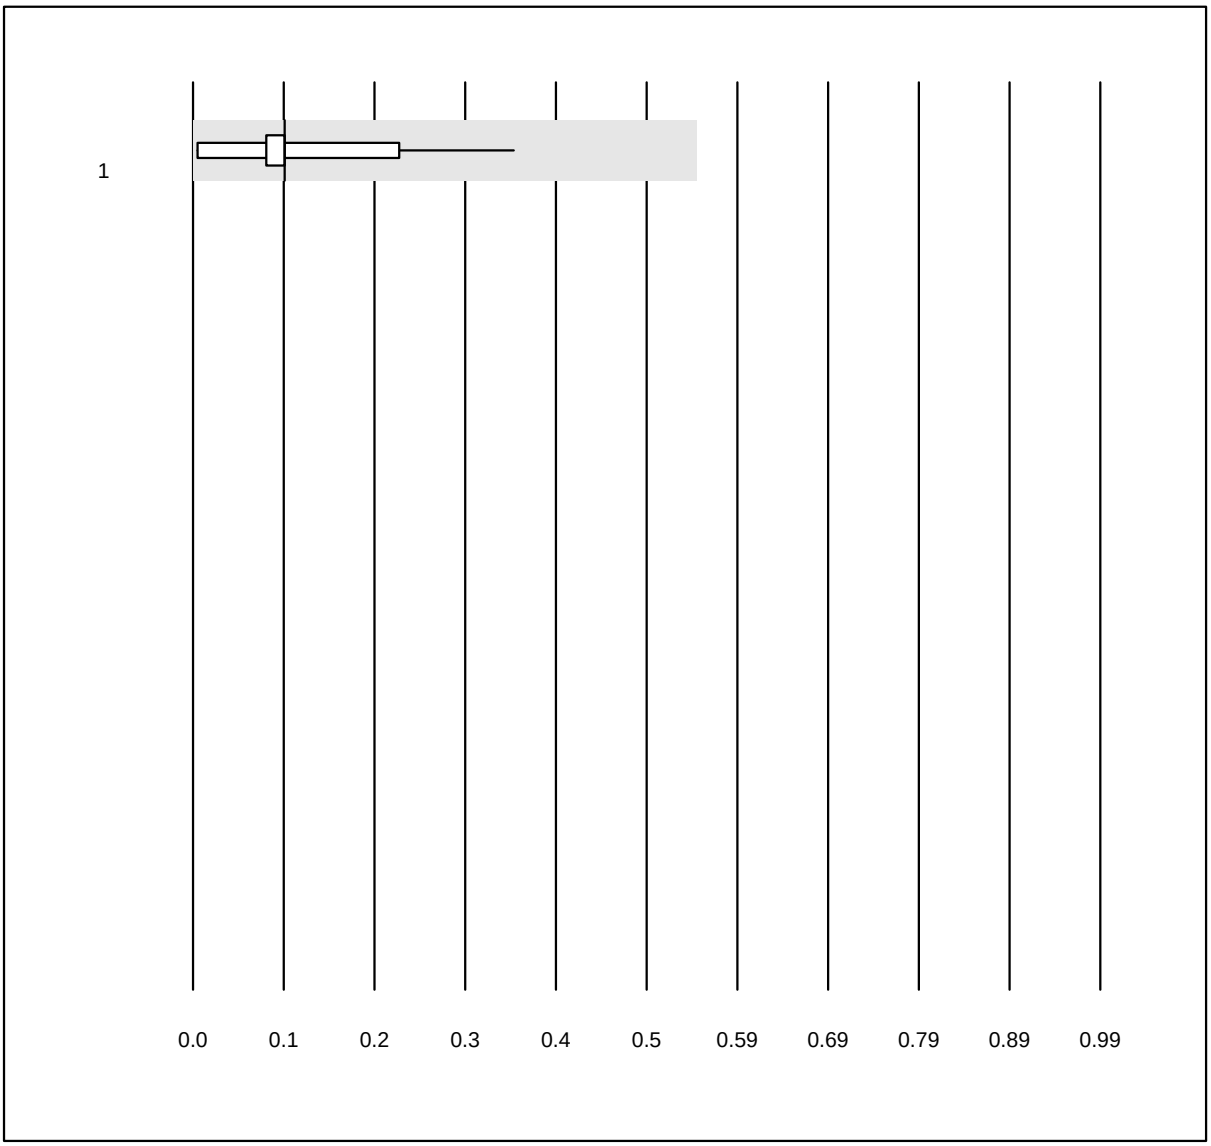


QUALAB Toleranz: 30%
(< 1.5: +/- 0.45 kU/L)

IgE épithélium du chat qn
(kU/L)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	toutes les méthodes	14	100.0	0.0	0.0	0.10	83.0	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

IgE fx5 qn

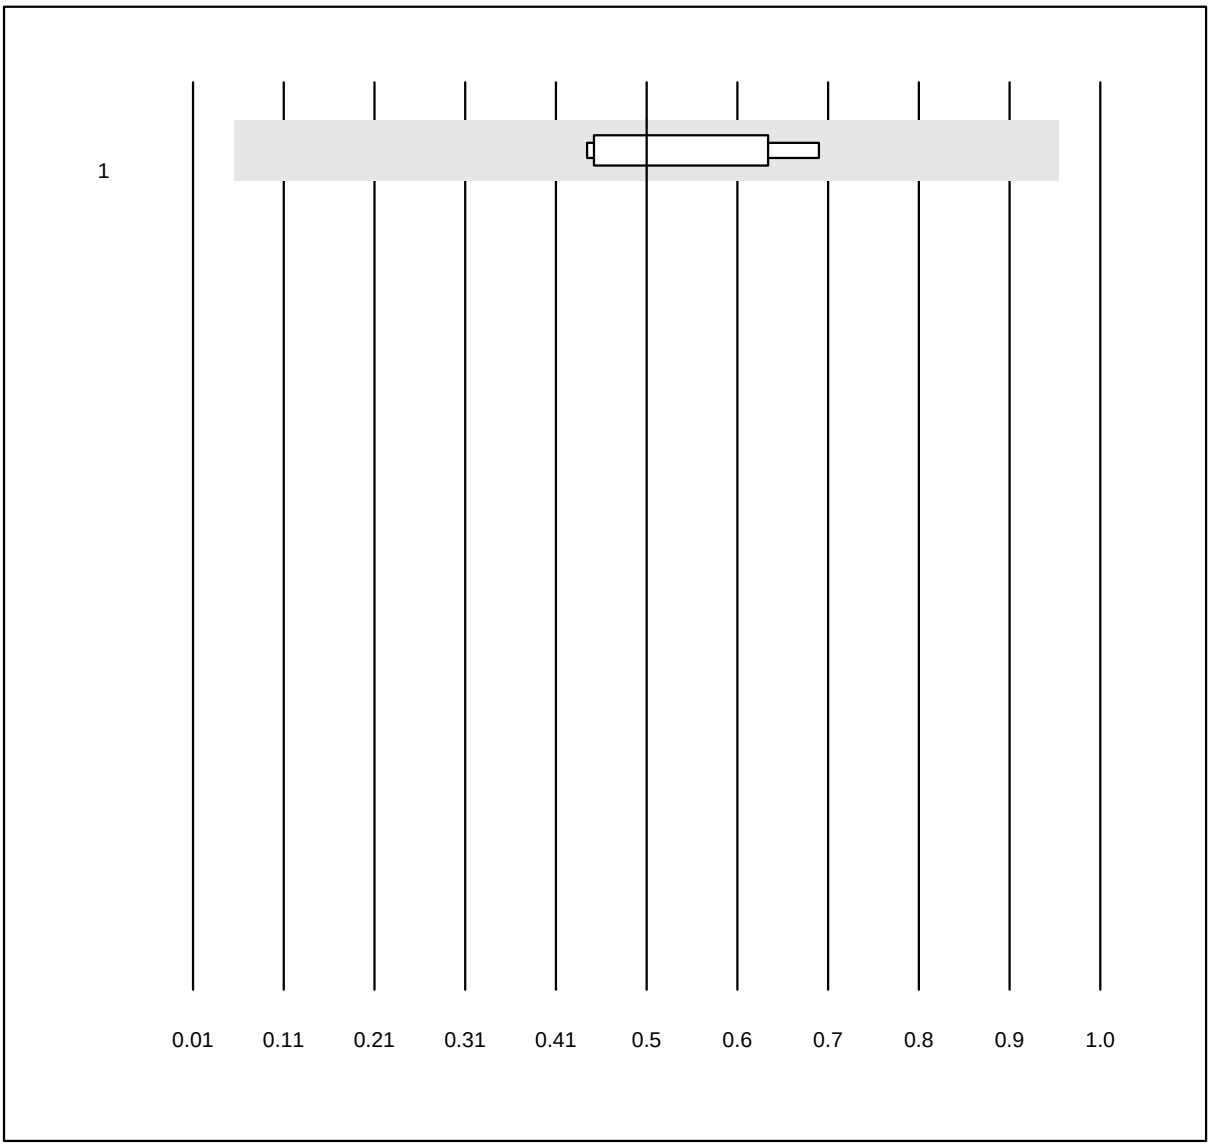


MQ Toleranz: 30%
(< 1.5: +/- 0.45 kU/L)

IgE fx5 qn (kU/L)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	toutes les méthodes	8	100.0	0.0	0.0	0.51	18.3	e

IgE rx1qn

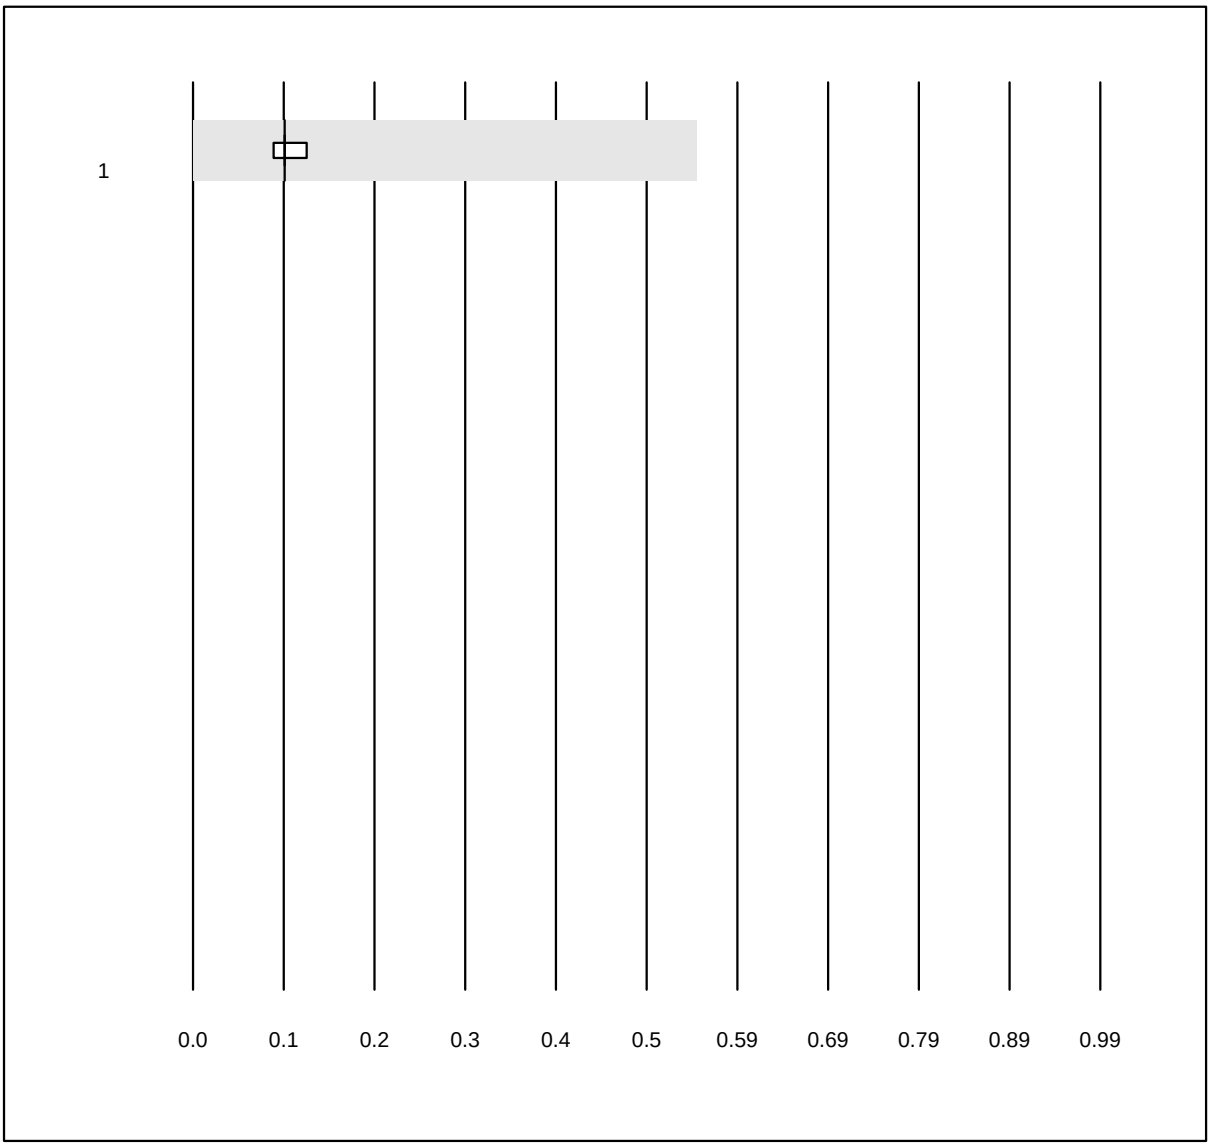


MQ Toleranz: 30%
(< 1.5: +/- 0.45 kU/L)

IgE rx1qn (kU/L)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	0.10	8.9	e

IgE rx2 qn

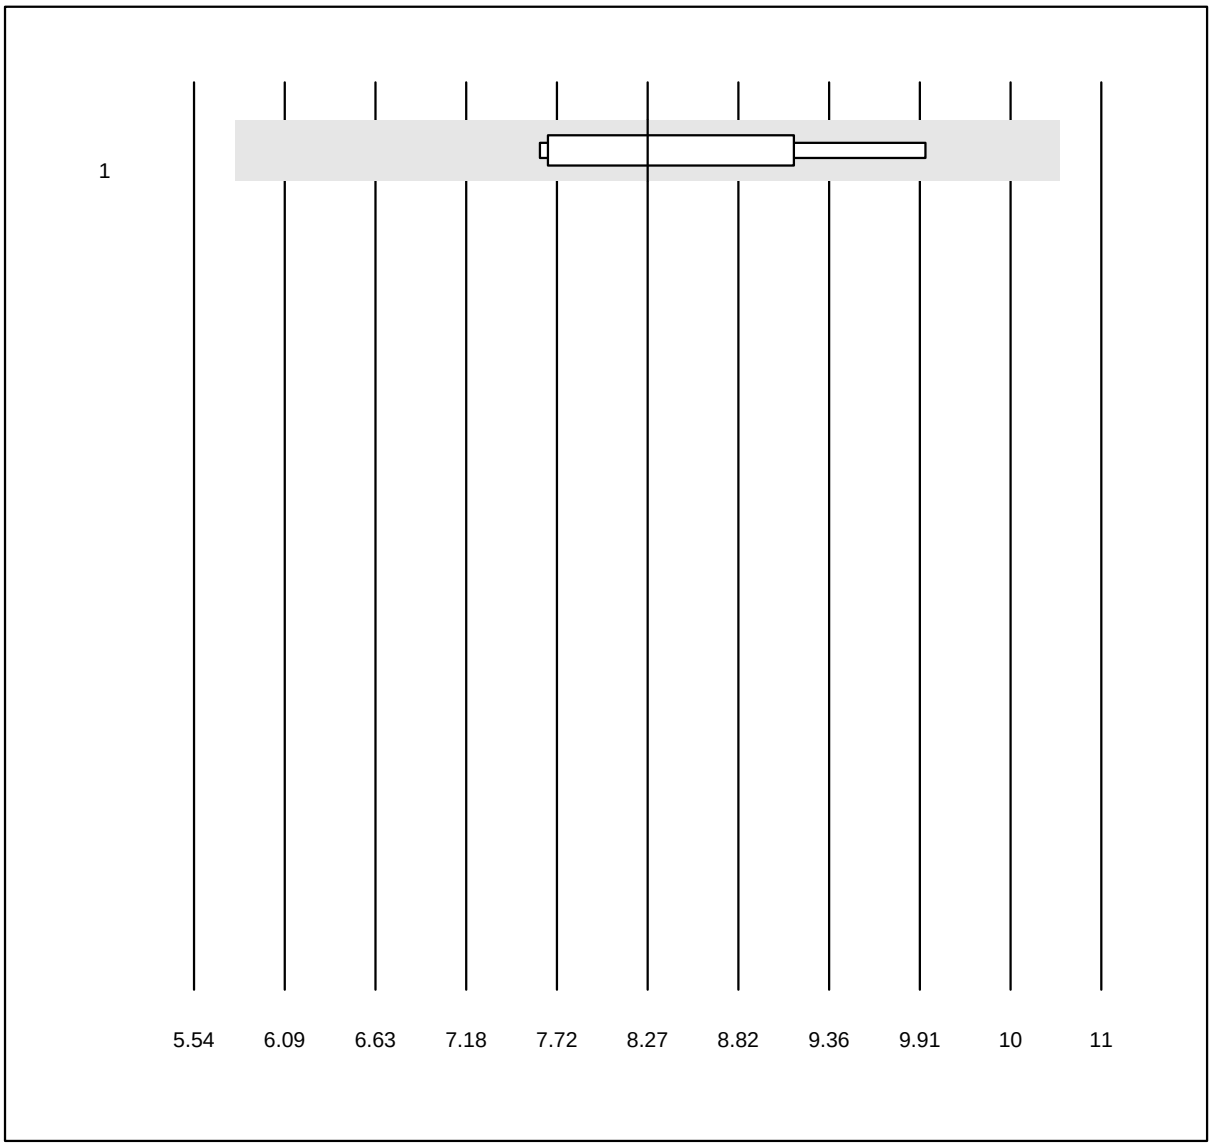


MQ Toleranz: 30%

IgE rx2 qn (kU/L)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	toutes les méthodes	7	100.0	0.0	0.0	8.27	10.1	e*

IgE sx1 qn

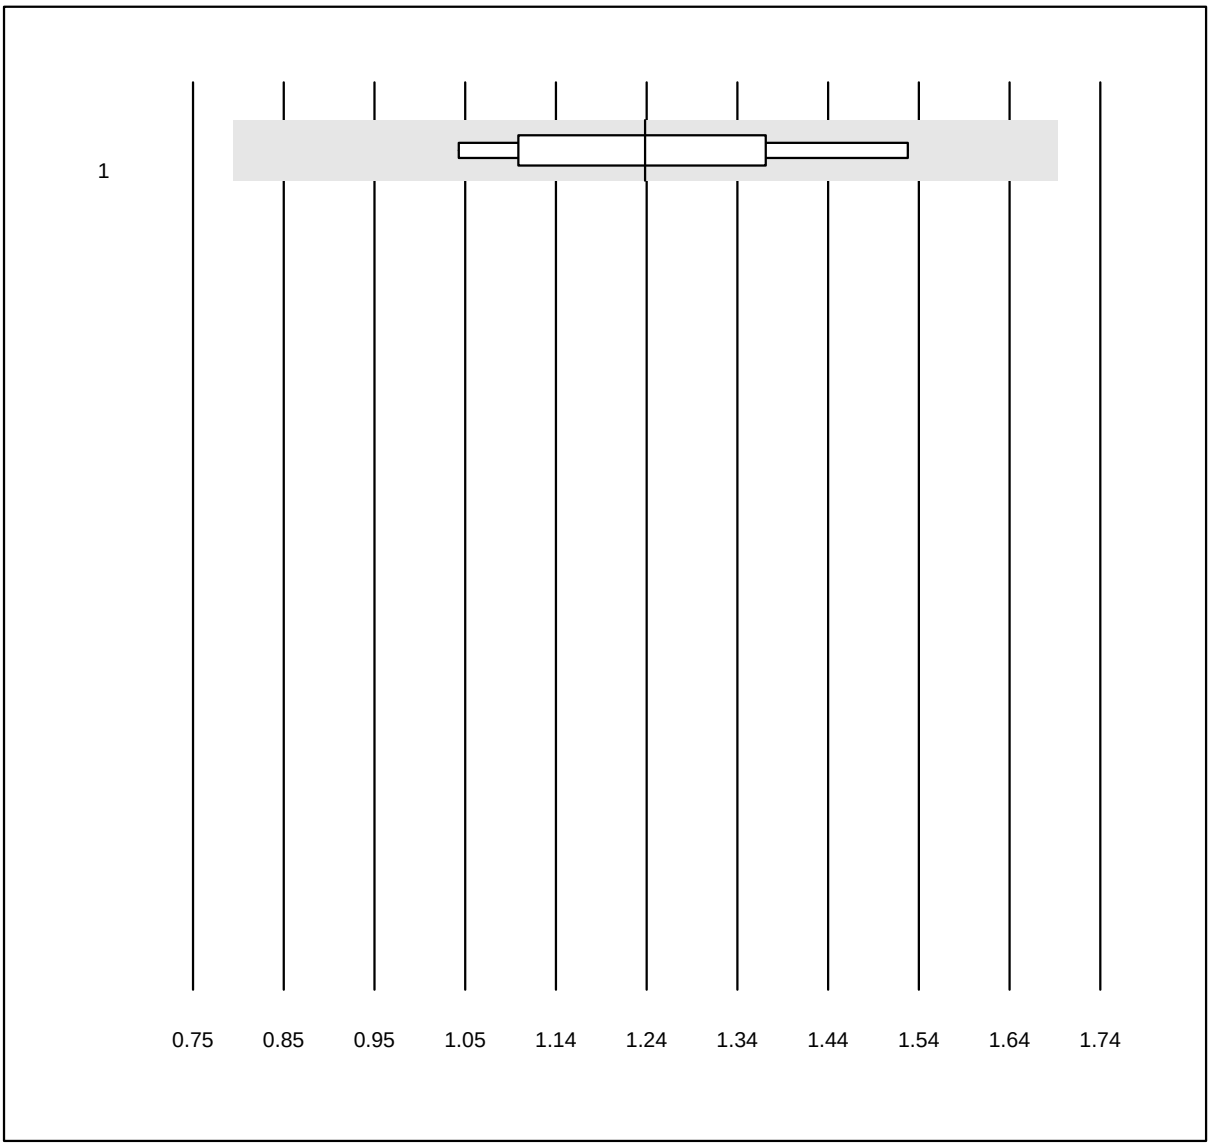


MQ Toleranz: 30%
(< 1.5: +/- 0.45 kU/L)

IgE sx1 qn (kU/L)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	toutes les méthodes	9	100.0	0.0	0.0	1.24	12.9	e

IgE totale

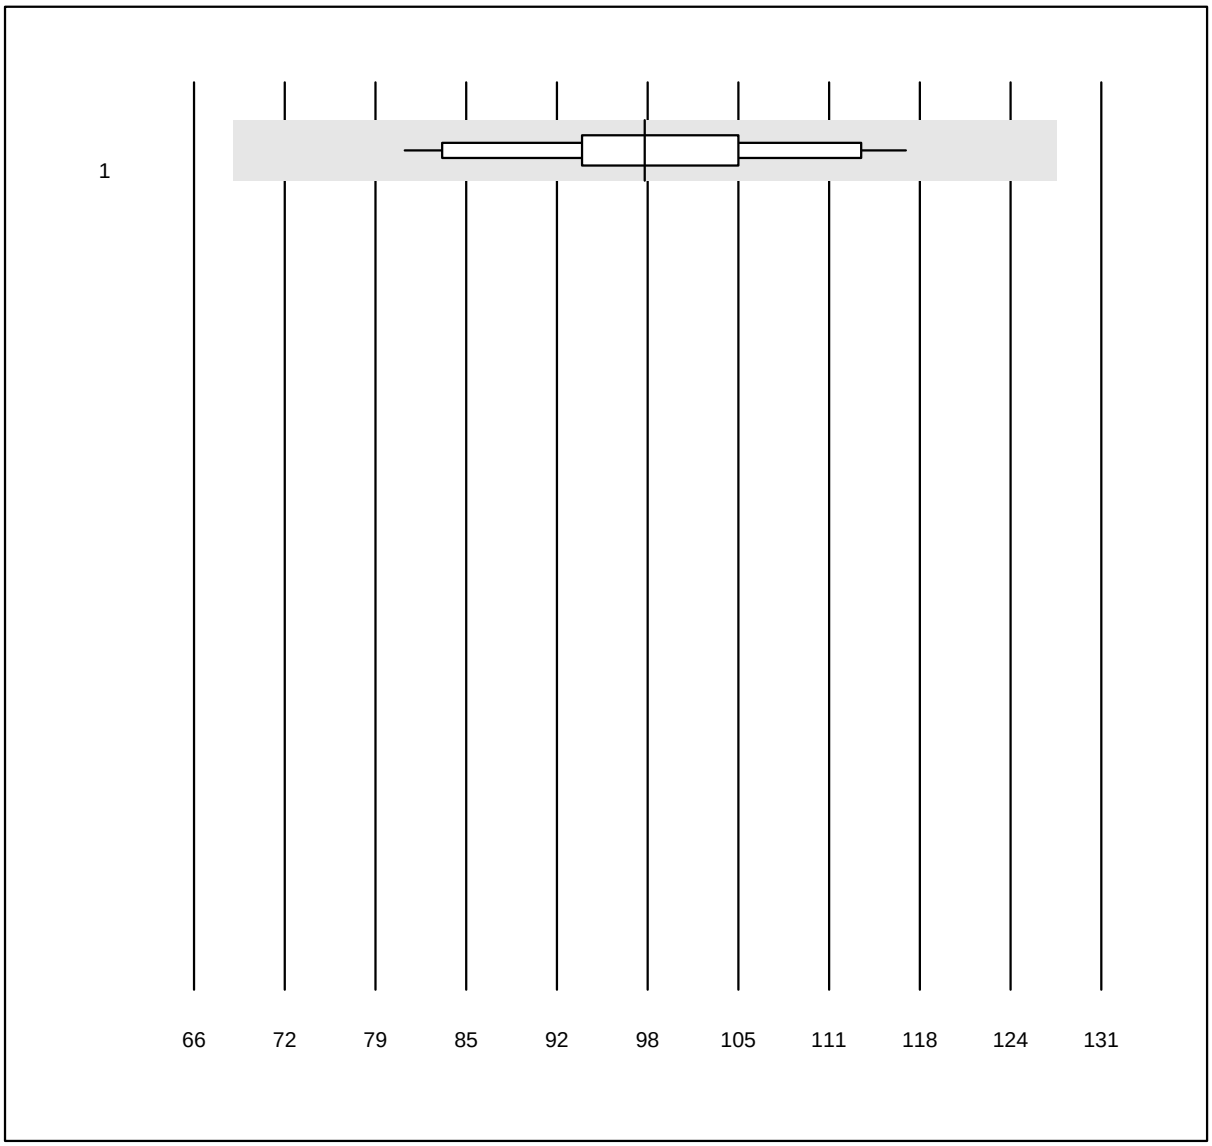


QUALAB Toleranz: 30%

IgE totale (kU/L)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	toutes les méthodes	13	100.0	0.0	0.0	98	9.5	e

CRP HS

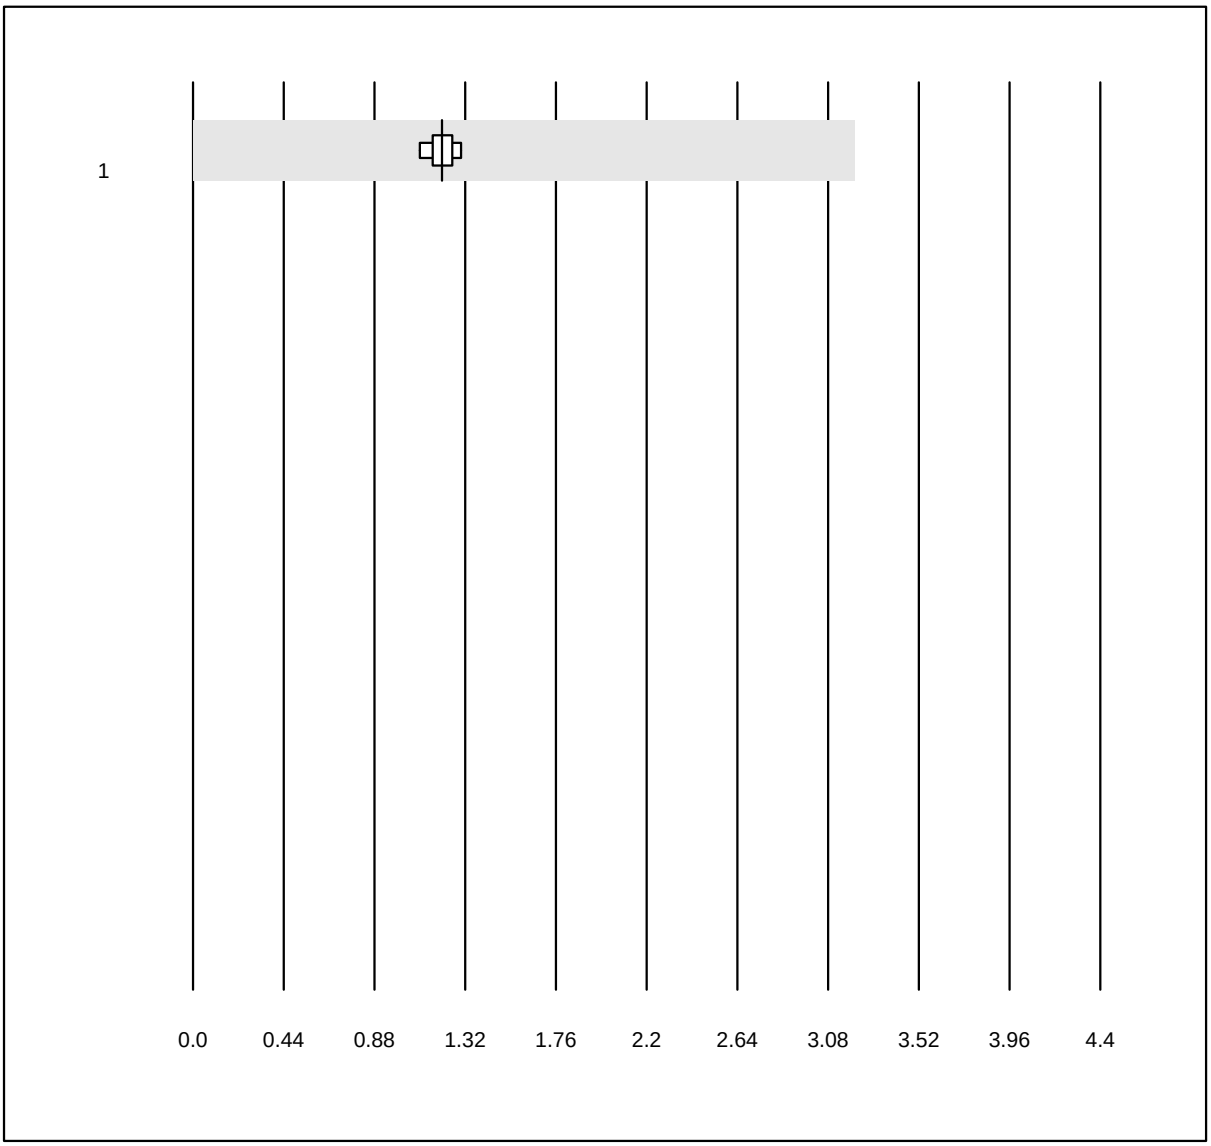


QUALAB Toleranz: 21%
(< 10.0: +/- 2.0 mg/l)

CRP HS (mg/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Turbidimetrie	12	100.0	0.0	0.0	1.21	5.5	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Apolipoprotéine A1

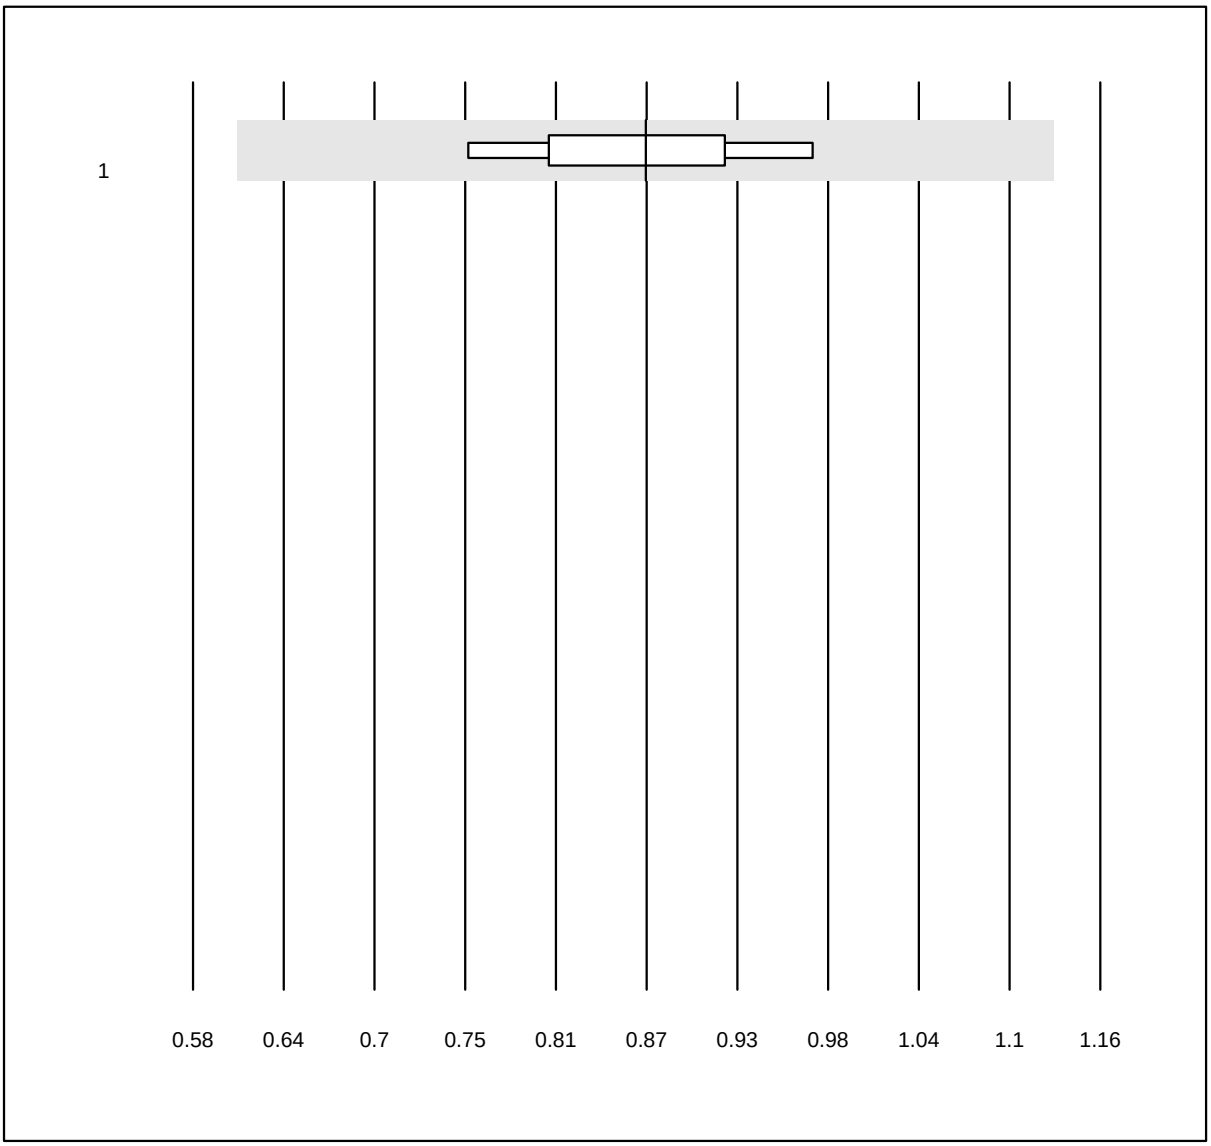


MQ Toleranz: 30%

Apolipoprotéine A1 (g/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Autres méthodes	8	100.0	0.0	0.0	0.87	8.0	e

Apolipoprotéine B

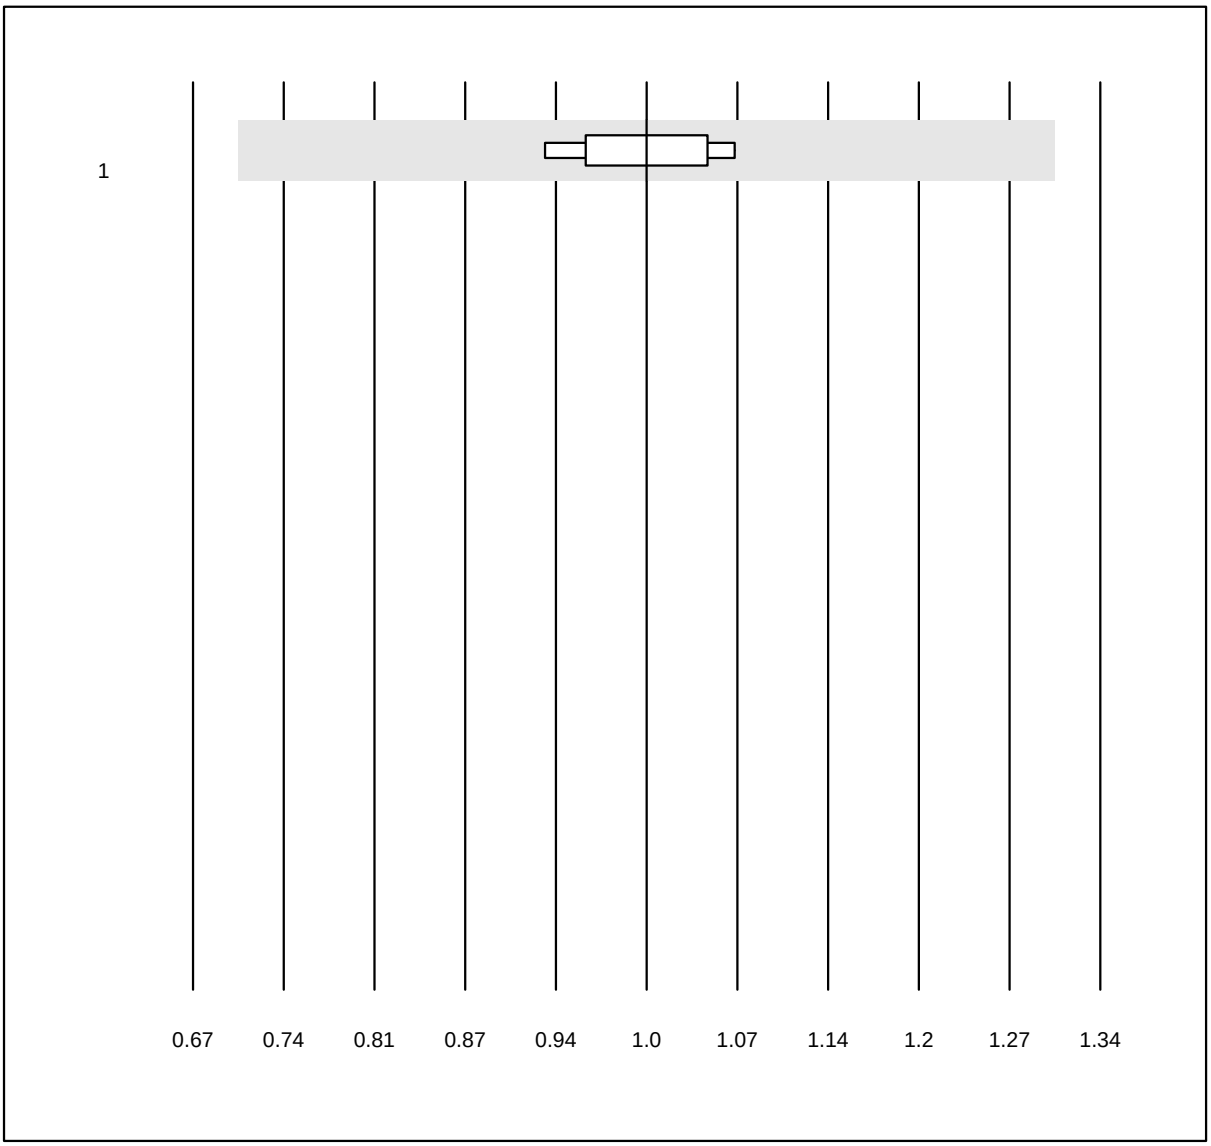


MQ Toleranz: 30%

Apolipoprotéine B (g/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Autres méthodes	9	100.0	0.0	0.0	1.00	5.0	e

Lipoprotéine (a)

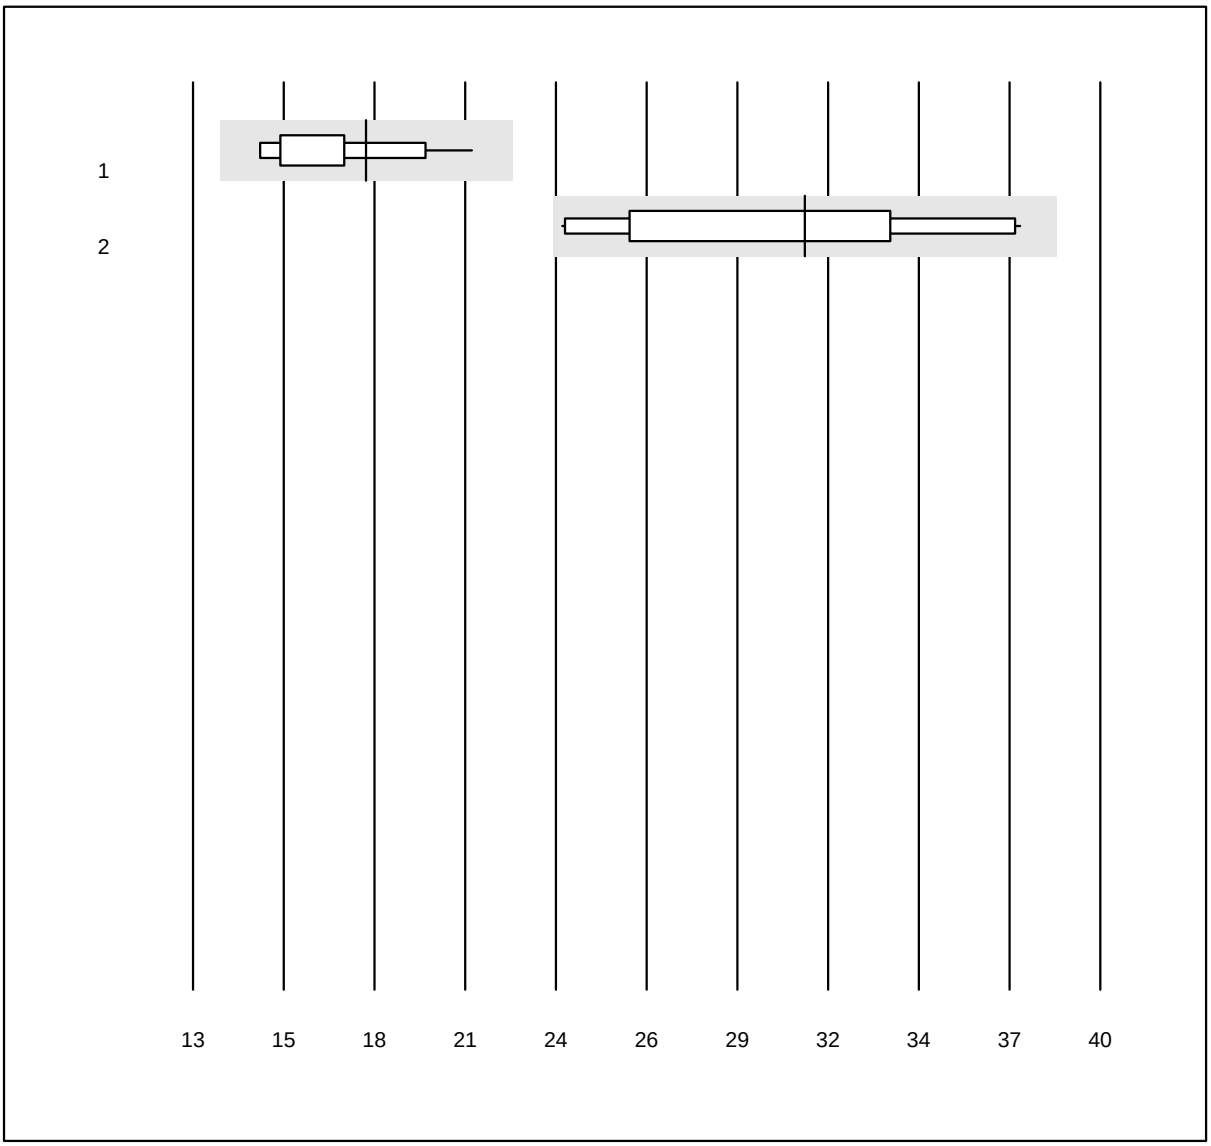


QUALAB Toleranz: 24%

Lipoprotéine (a) (nmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	15	100.0	0.0	0.0	18	10.0	a
2	Andere	10	100.0	0.0	0.0	31	15.8	a*

CRP

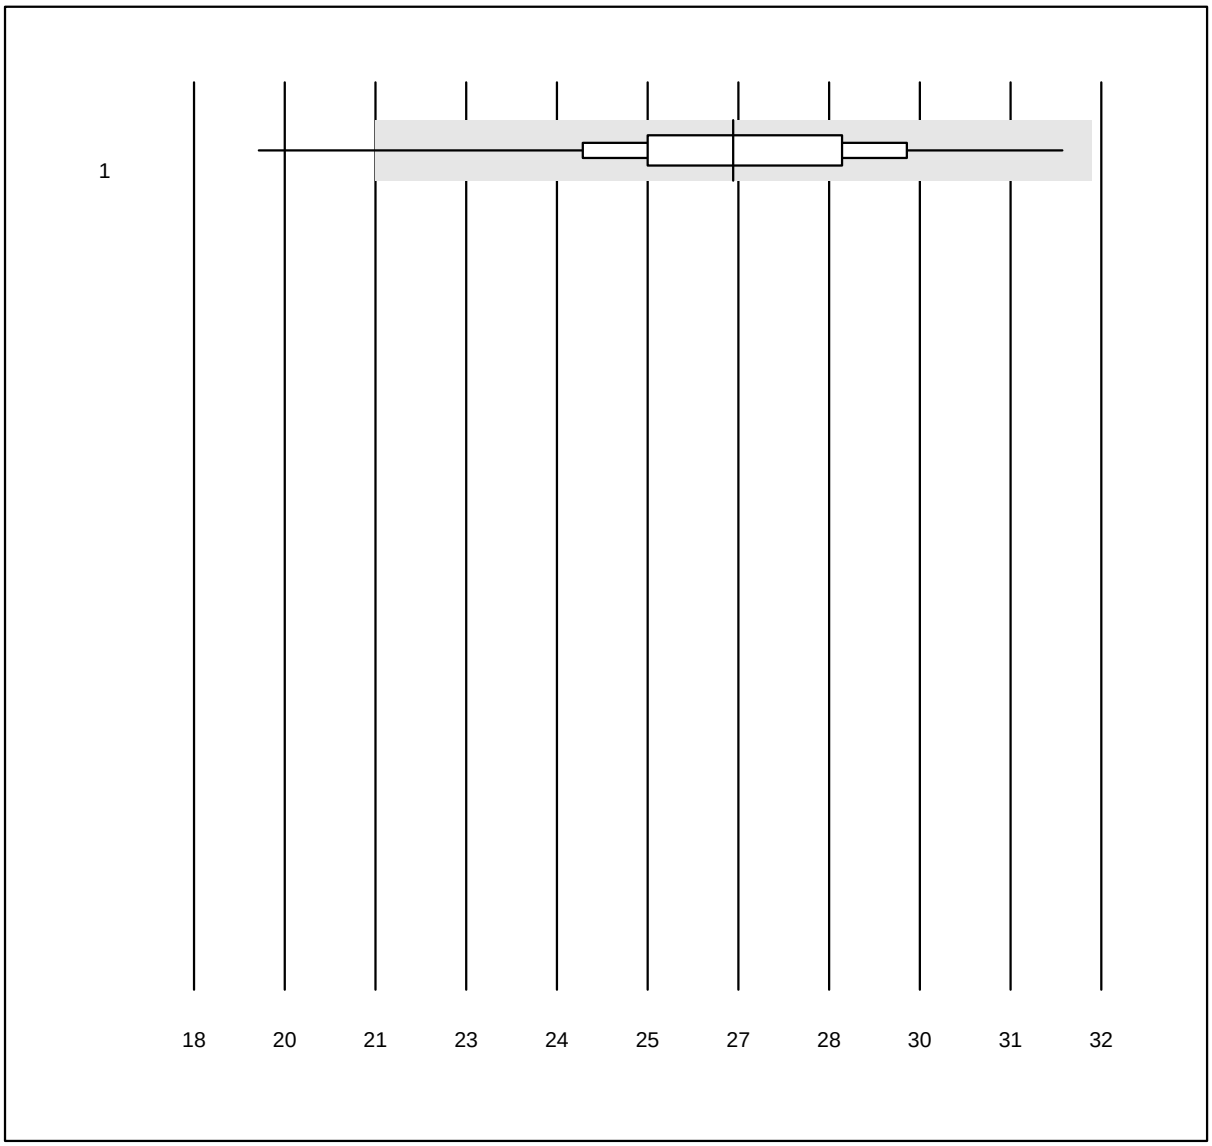


QUALAB Toleranz: 21%

CRP (mg/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	AFIAS	239	98.3	0.4	1.3	26.3	7.5	e

Anti deam. Gliadin IgA

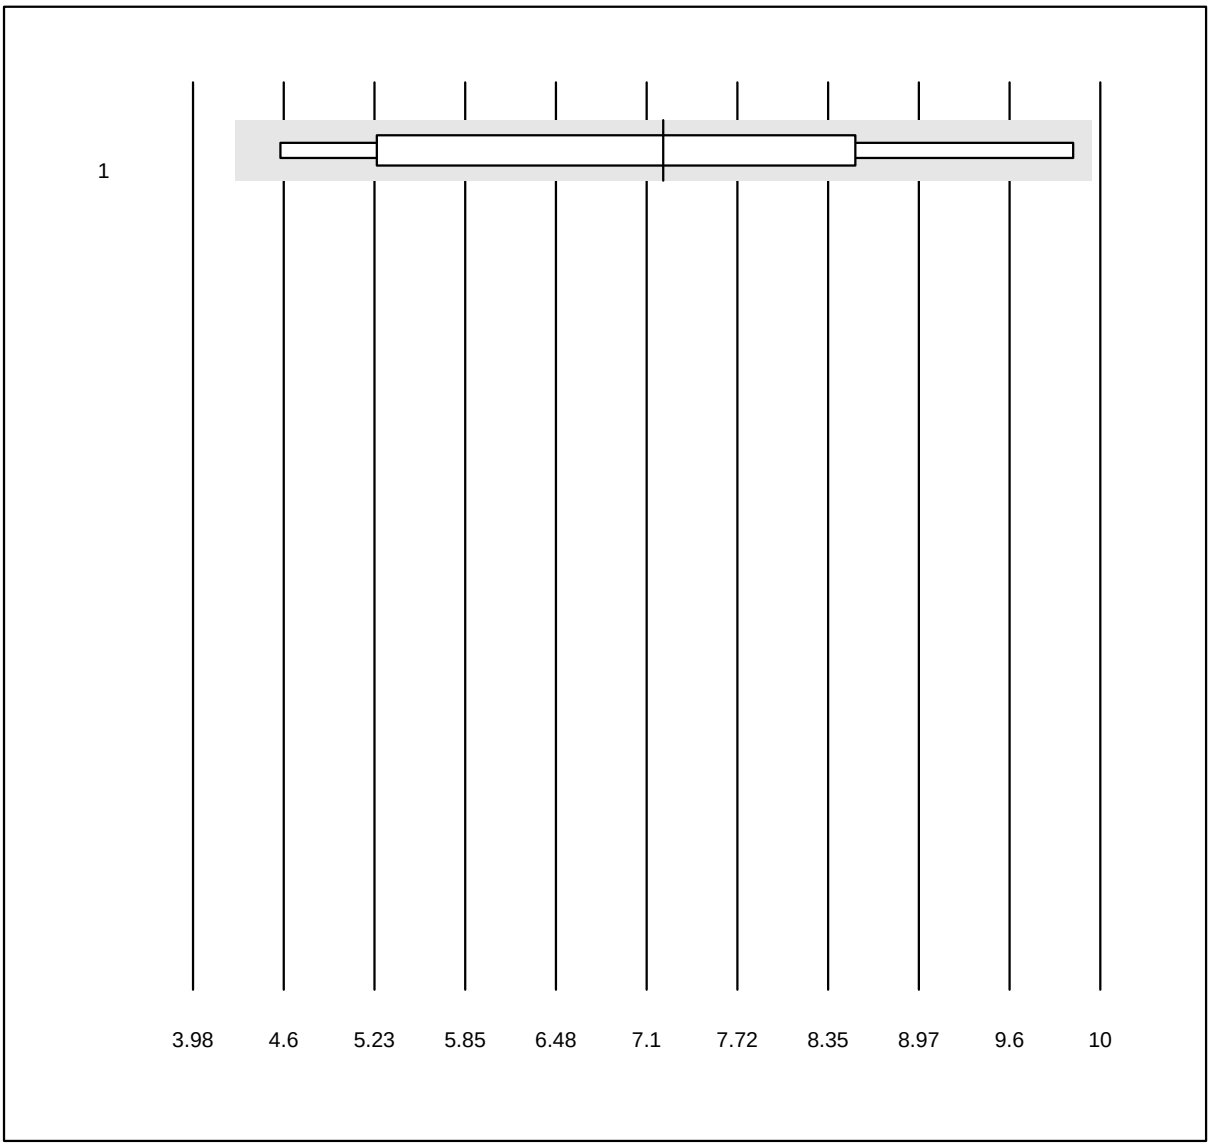


MQ Toleranz: 40%

Anti deam. Gliadin IgA
(U/ml)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Phadia	8	100.0	0.0	0.0	7.10	25.3	a*

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Anti deam. Gliadin IgG

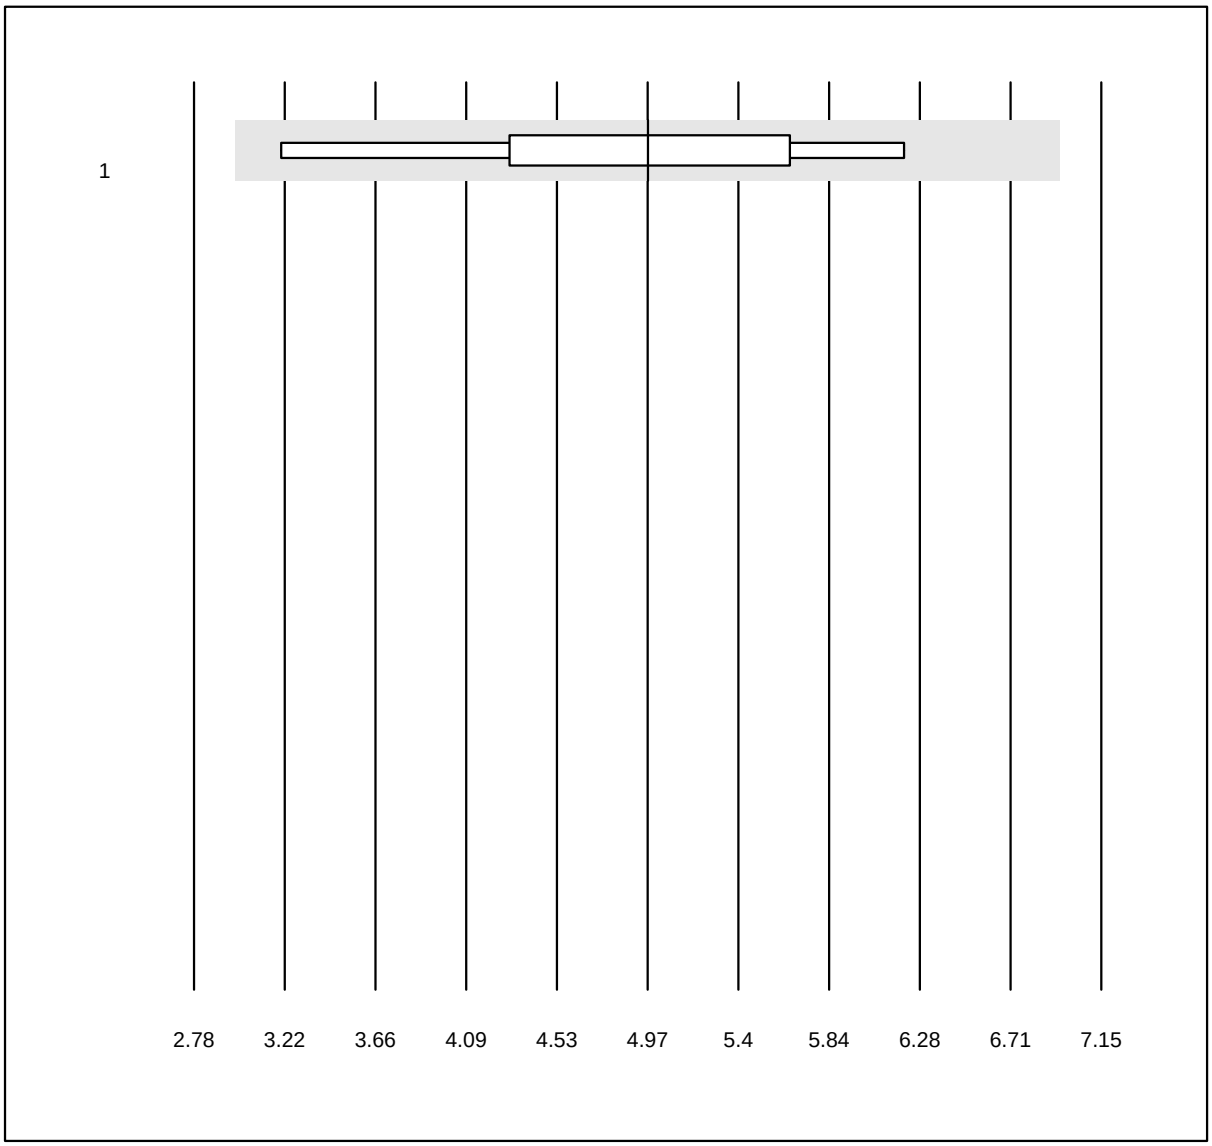


MQ Toleranz: 40%

Anti deam. Gliadin IgG
(U/ml)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Phadia	9	100.0	0.0	0.0	4.97	18.6	e*

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Anti tTG IgA

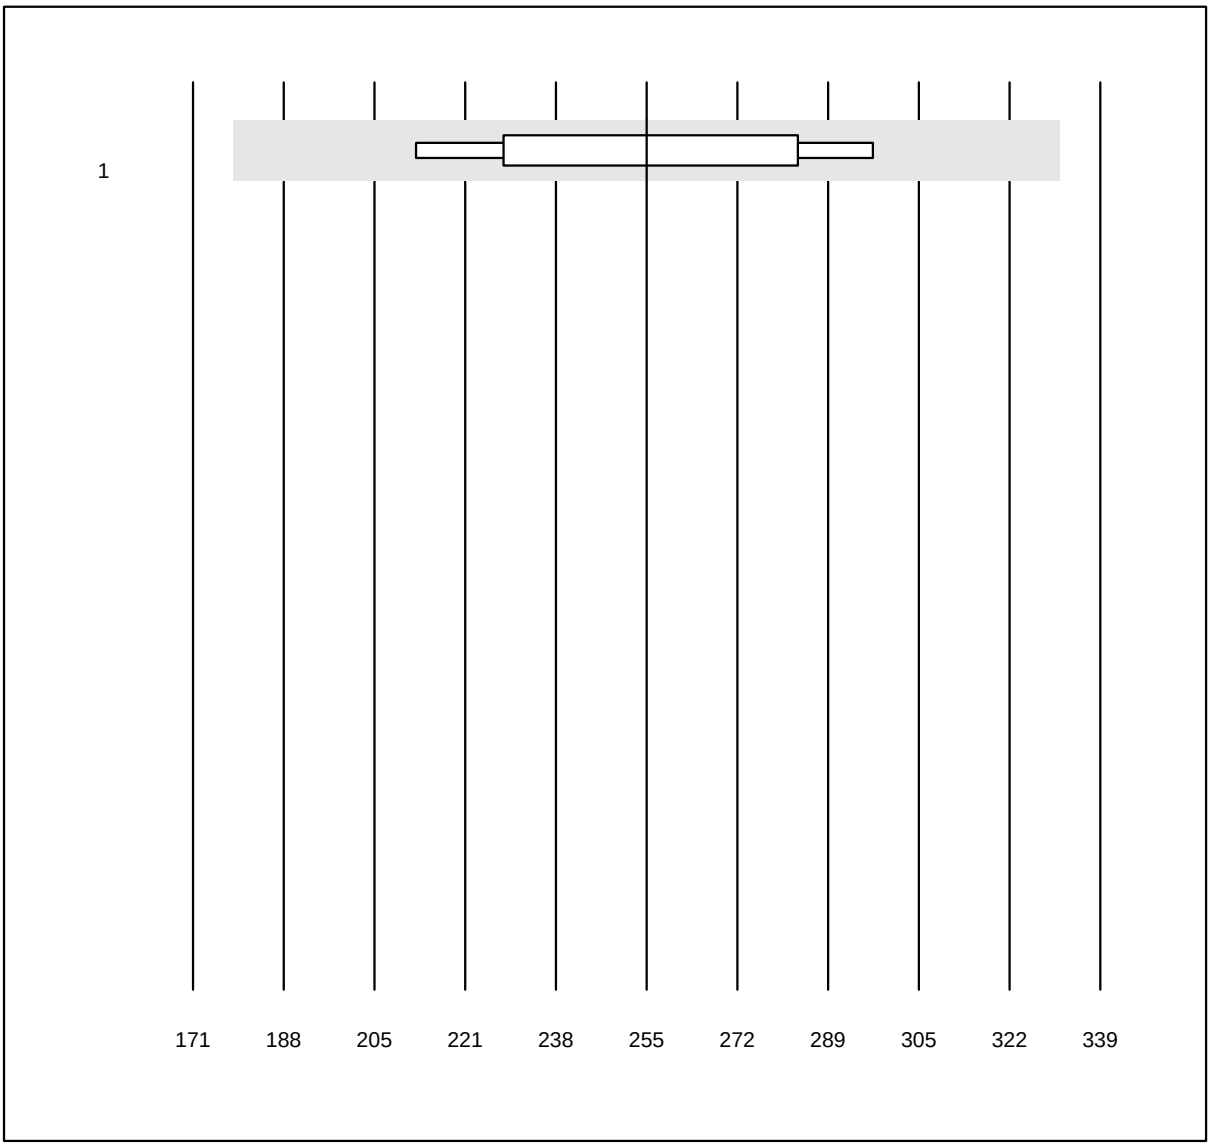


MQ Toleranz: 30%

Anti tTG IgA (U/ml)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Phadia	8	100.0	0.0	0.0	255.00	11.4	a*

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Anti tTG IgG

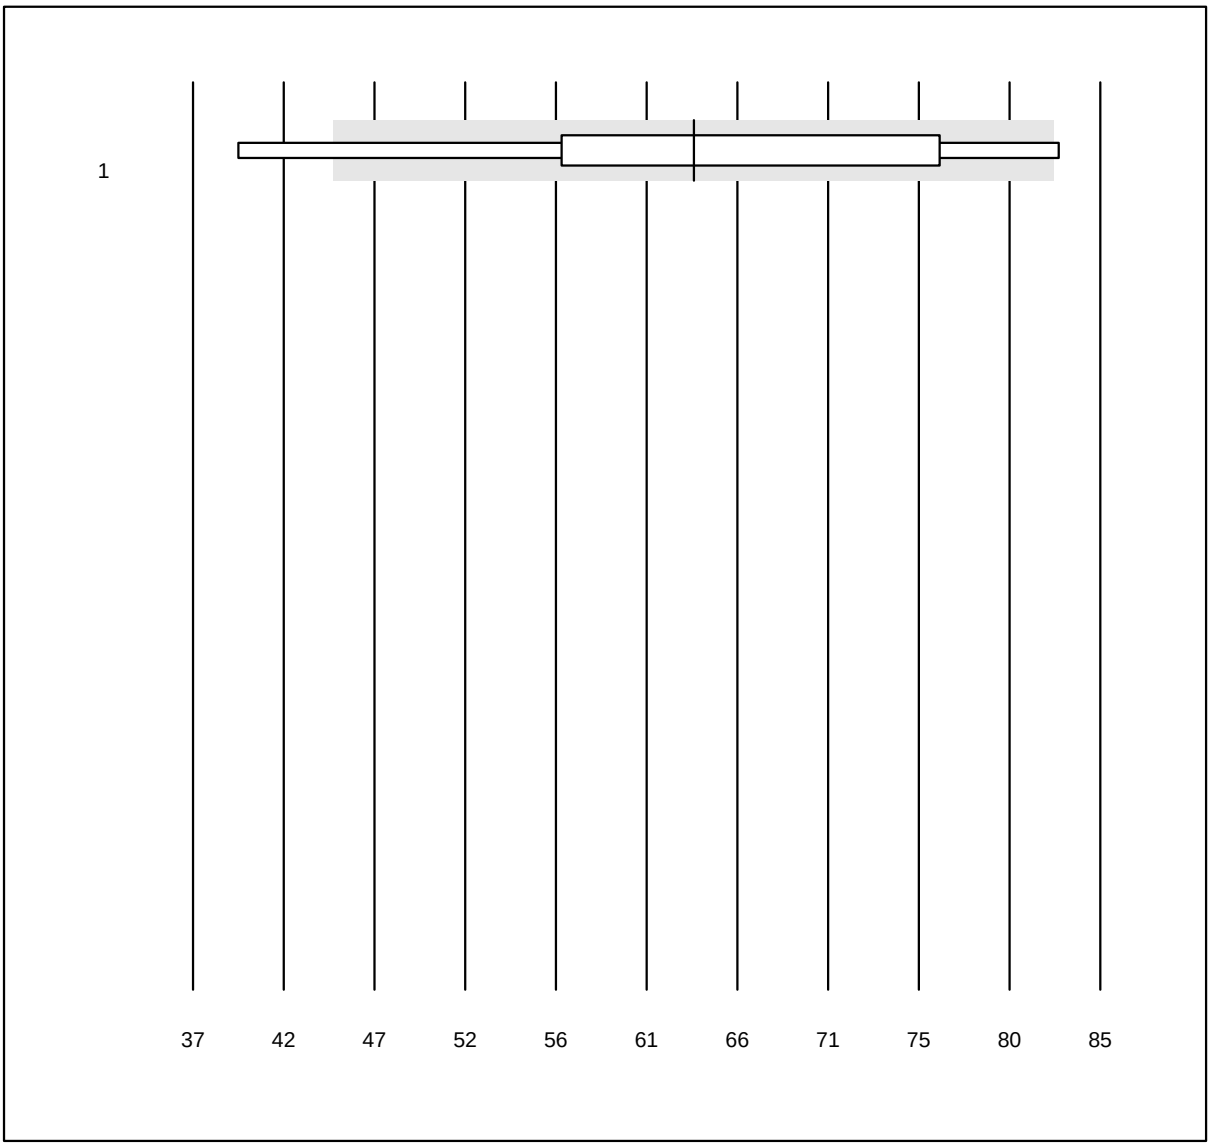


MQ Toleranz: 30%

Anti tTG IgG (U/ml)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Autres méthodes	6	83.3	0.0	16.7	63.50	18.5	a*

CRP Lumira

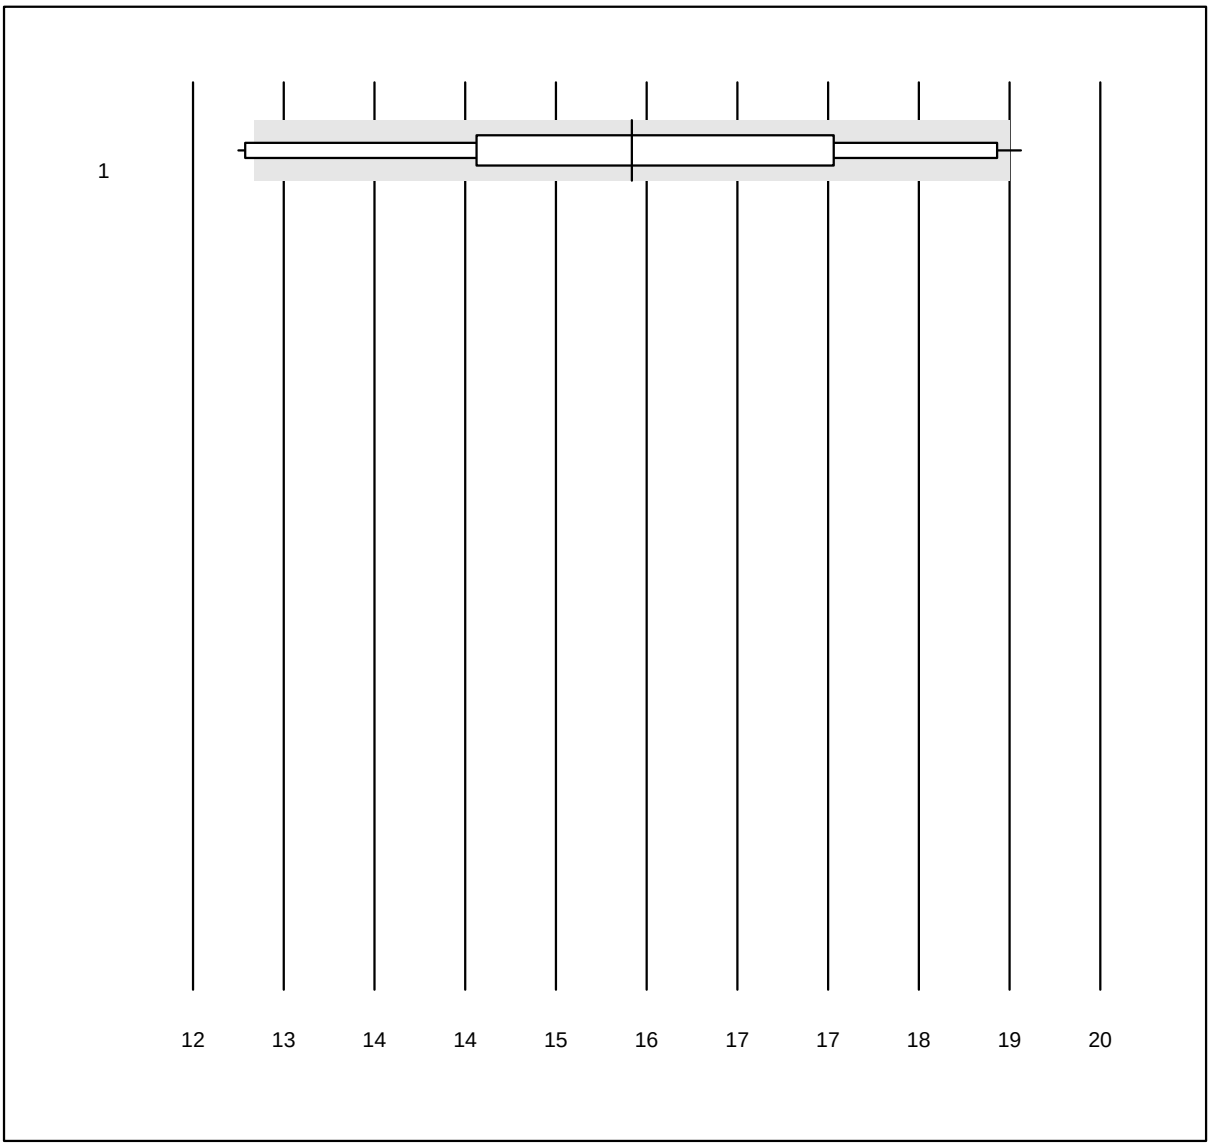


QUALAB Toleranz: 21%

CRP Lumira (mg/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Lumira Dx	13	76.9	15.4	7.7	15.9	13.6	e*

Transaminase GPT/ALT 1

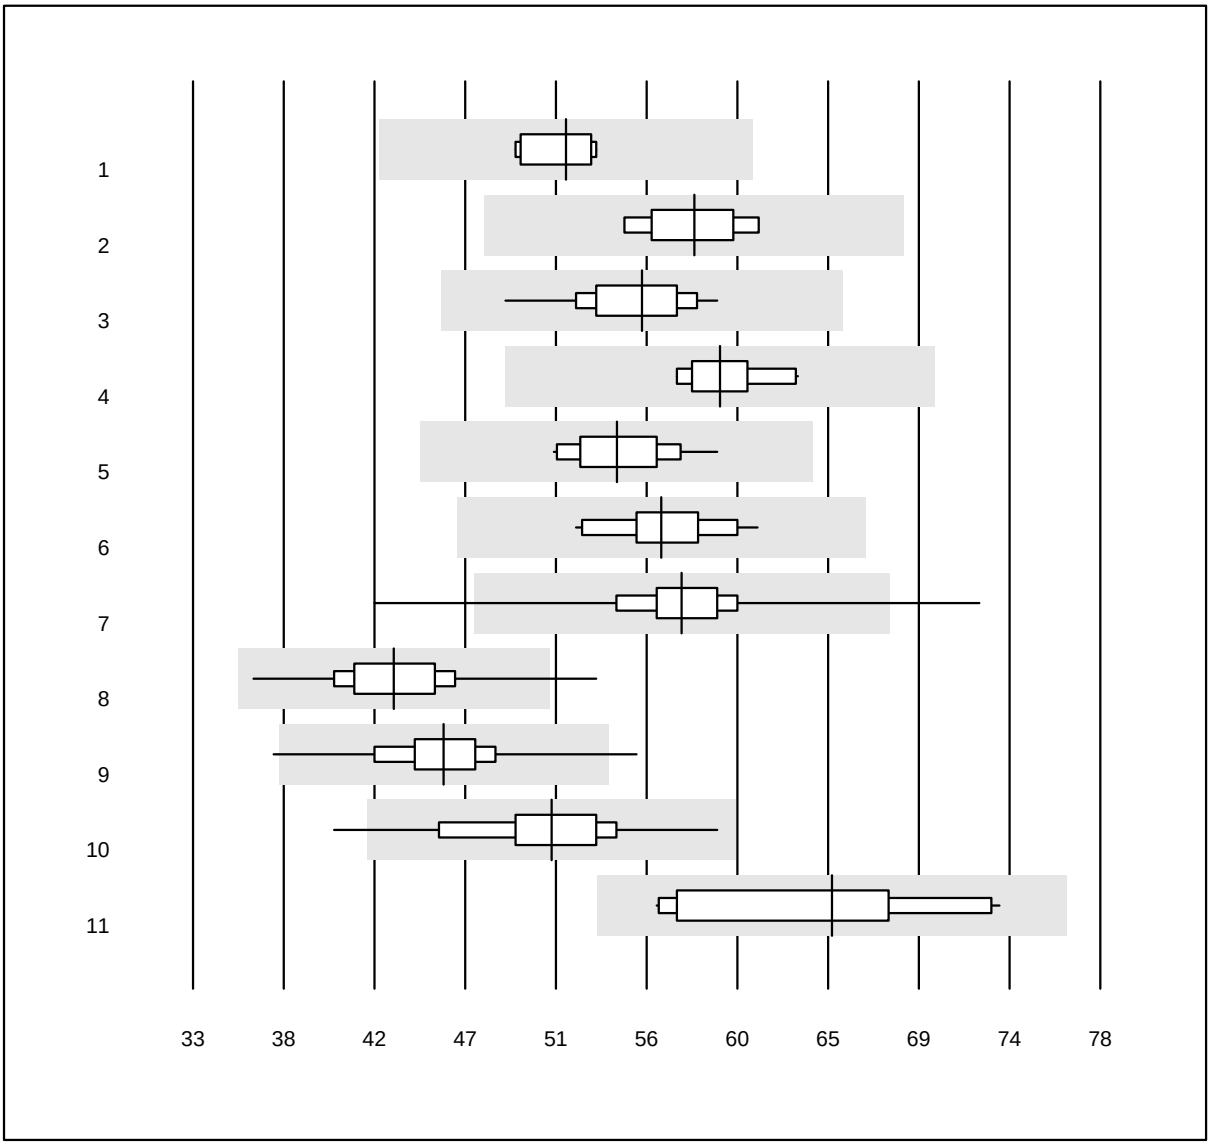


QUALAB Toleranz: 18%

Transaminase GPT/ALT
(U/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	8	100.0	0.0	0.0	52	3.2	e
2	Beckman	5	100.0	0.0	0.0	58	3.7	e
3	Roche	49	100.0	0.0	0.0	55	4.4	e
4	Siemens	10	100.0	0.0	0.0	59	3.5	e
5	Autolyser	23	100.0	0.0	0.0	54	4.3	e
6	Selectra Pro	14	100.0	0.0	0.0	56	4.3	e
7	Fuji Dri-Chem	1189	98.3	0.5	1.2	57	4.7	e
8	Spotchem D-Concept	661	98.9	0.3	0.8	43	5.8	e
9	Spotchem SP-4430	125	97.6	1.6	0.8	45	5.9	e
10	Piccolo	74	94.6	1.4	4.1	51	6.6	e
11	Seamaty	11	90.9	0.0	9.1	65	8.8	e*

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Transaminase GPT/ALT 2

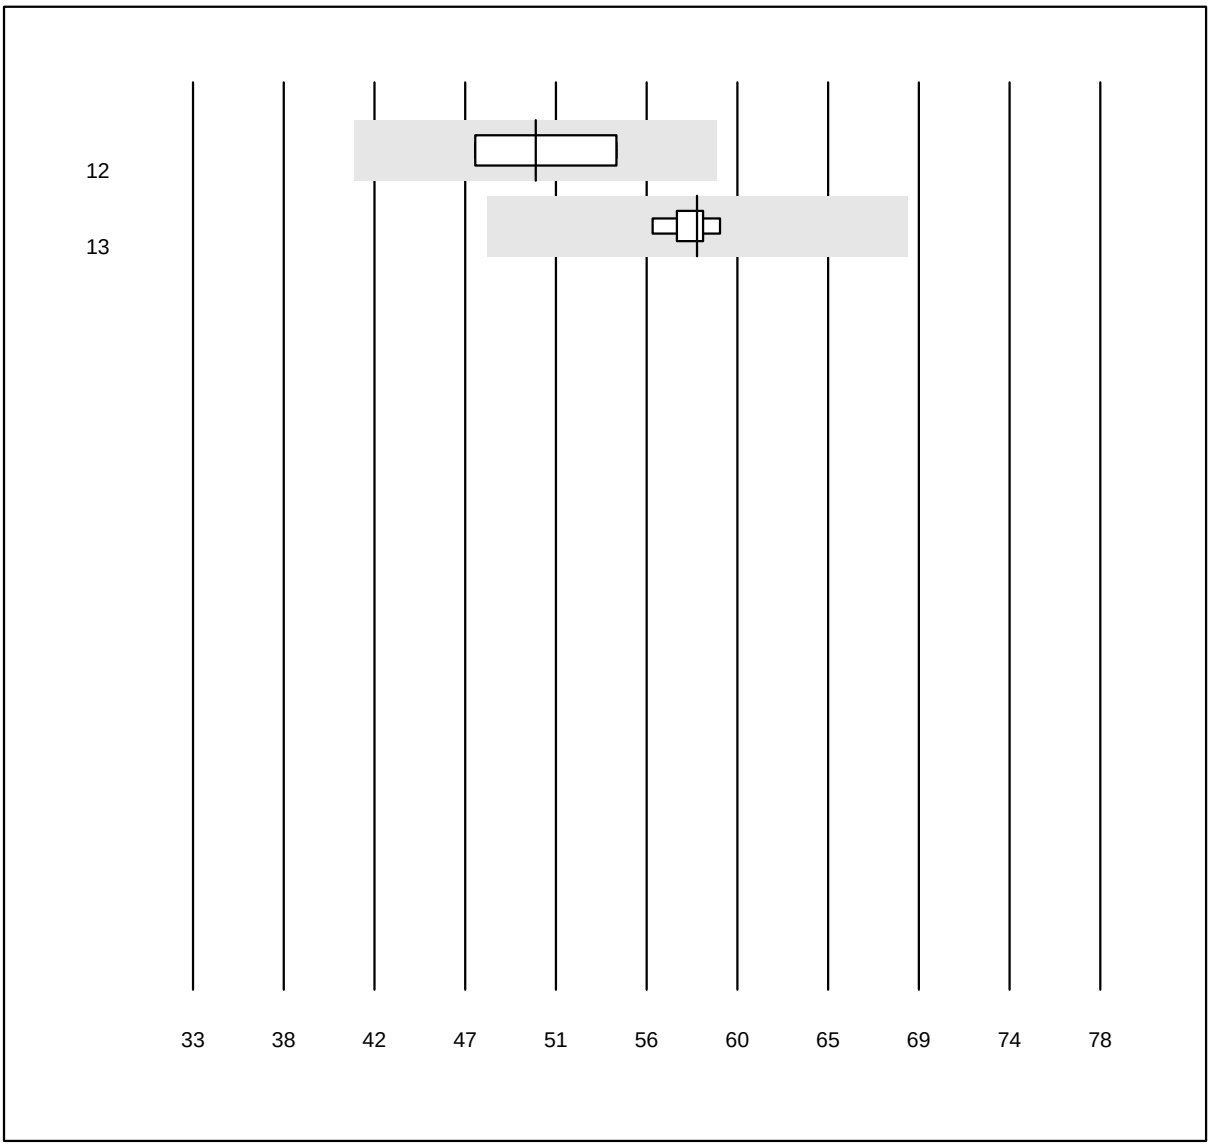


QUALAB Toleranz: 18%

Transaminase GPT/ALT
(U/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
12	Skyla	6	100.0	0.0	0.0	50	6.7	e*
13	Vitros	7	100.0	0.0	0.0	58	1.7	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Albumine 1

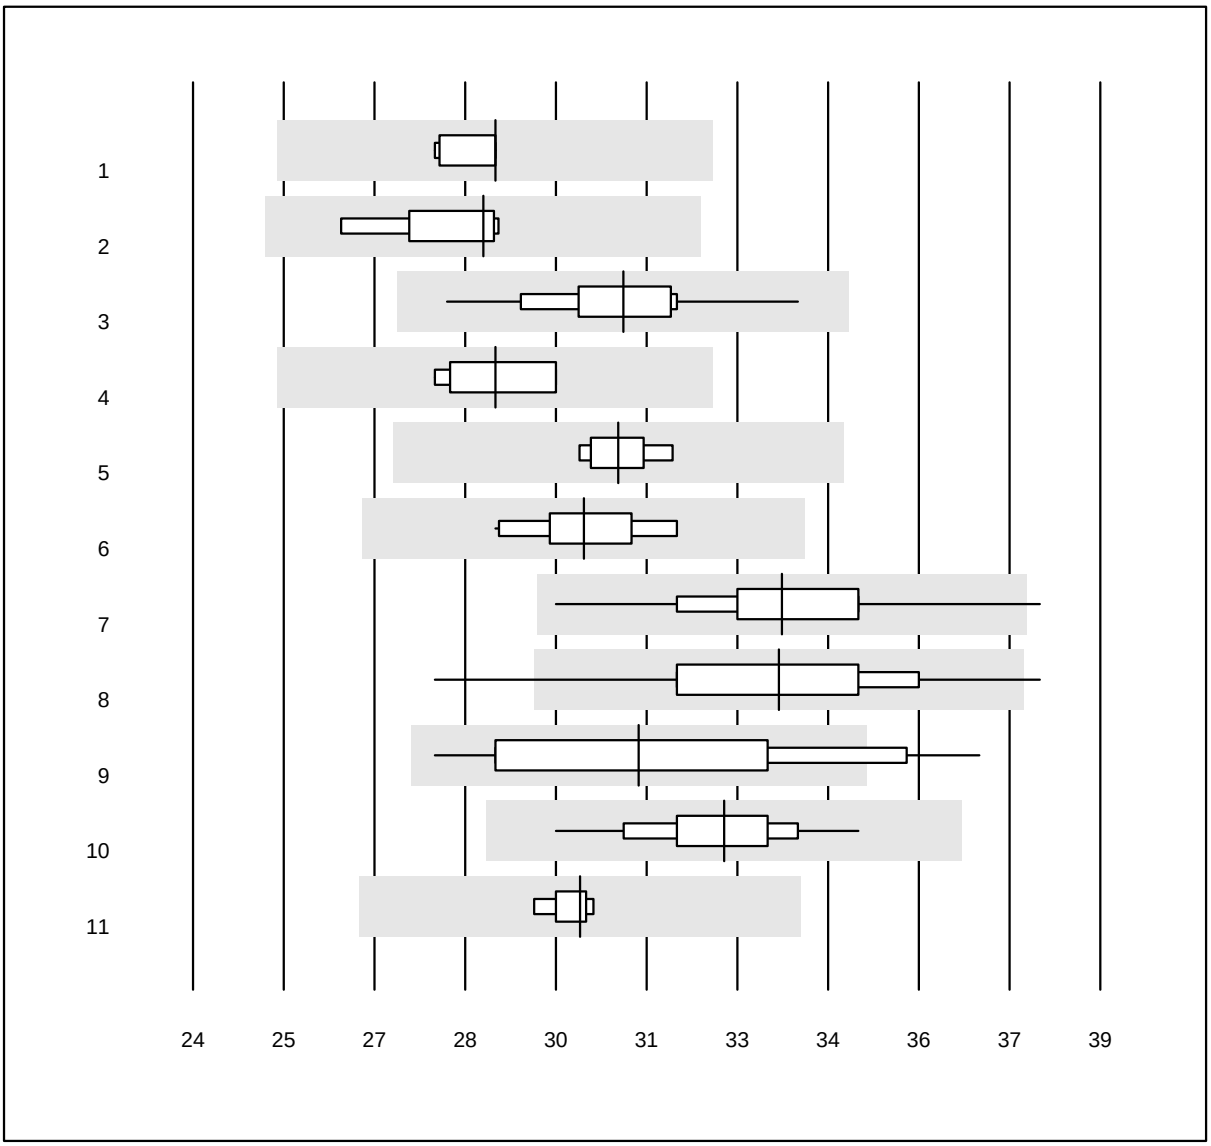


QUALAB Toleranz: 12%
(< 30.0: +/- 3.6 g/l)

Albumine (g/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	8	100.0	0.0	0.0	29.0	1.7	e
2	Beckman	4	100.0	0.0	0.0	28.8	3.0	e
3	Roche	42	100.0	0.0	0.0	31.1	3.6	e
4	Siemens	8	100.0	0.0	0.0	29.0	2.9	e
5	Autolyser	8	100.0	0.0	0.0	31.0	1.6	e
6	Selectra Pro	10	100.0	0.0	0.0	30.5	3.2	e
7	Fuji Dri-Chem	243	99.6	0.4	0.0	33.7	4.0	e
8	Spotchem D-Concept	242	97.5	2.1	0.4	33.7	5.2	e
9	Spotchem SP-4430	21	90.5	9.5	0.0	31.4	8.1	e*
10	Piccolo	66	98.5	0.0	1.5	32.8	3.4	e
11	Seamaty	7	100.0	0.0	0.0	30.4	1.1	e

Albumine 2

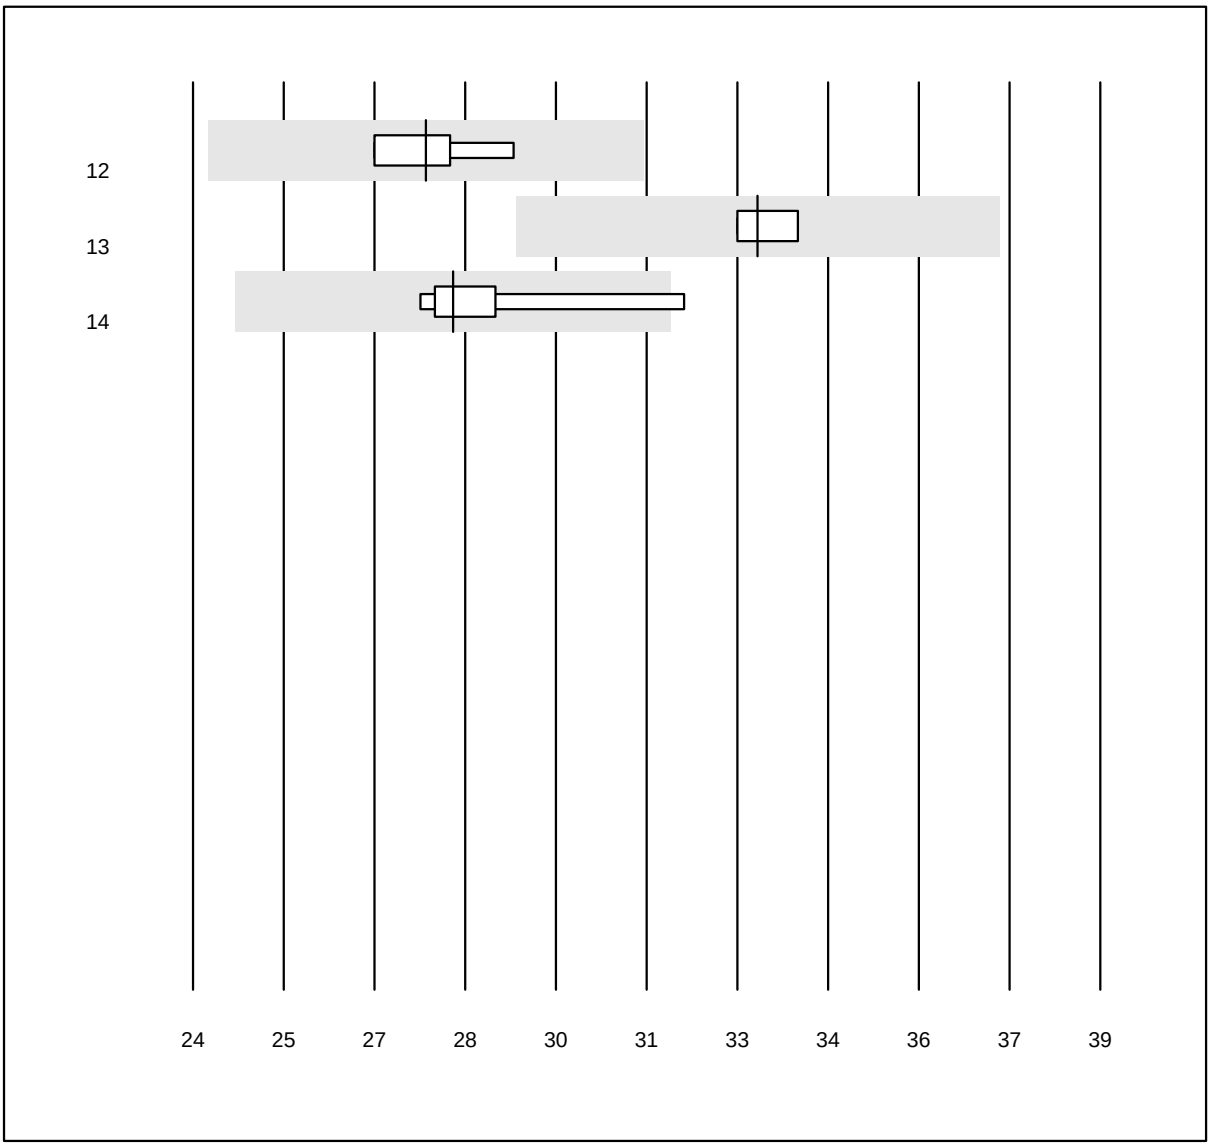


QUALAB Toleranz: 12%
(< 30.0: +/- 3.6 g/l)

Albumine (g/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
12	Vitros	6	100.0	0.0	0.0	27.9	2.7	e
13	Skyla	5	100.0	0.0	0.0	33.3	1.6	e
14	Turbidimetrie	7	100.0	0.0	0.0	28.3	4.6	e*

Phosphatase alcaline 1

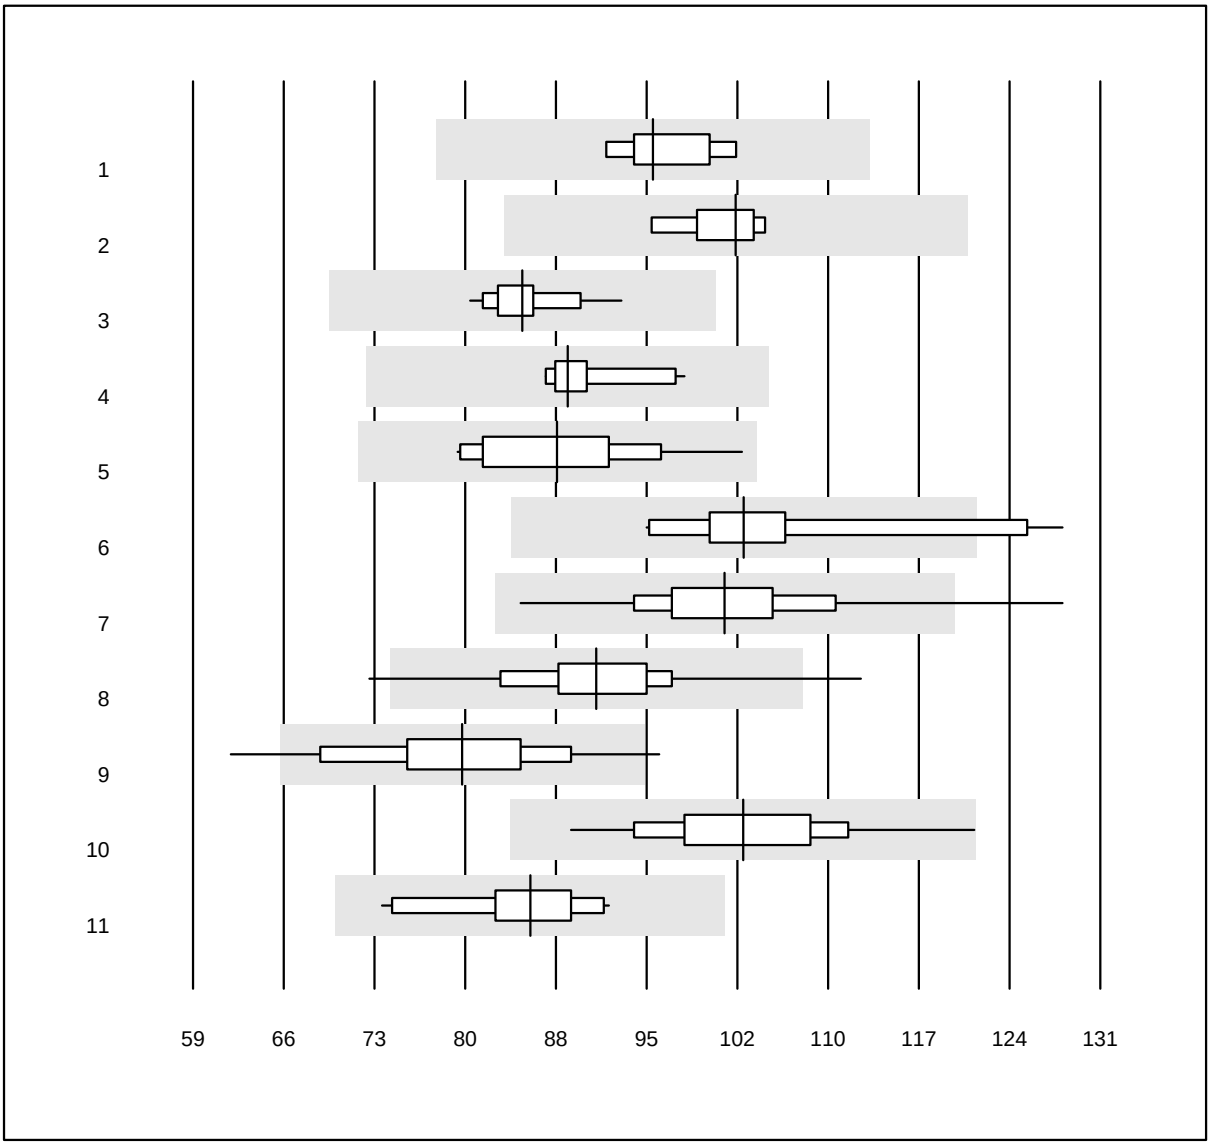


QUALAB Toleranz: 18%

Phosphatase alcaline (U/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	8	100.0	0.0	0.0	96	3.6	e
2	Beckman	5	100.0	0.0	0.0	102	2.7	e
3	Roche	47	100.0	0.0	0.0	85	3.4	e
4	Siemens	10	100.0	0.0	0.0	89	3.7	e
5	Autolyser	23	100.0	0.0	0.0	88	6.8	e
6	Selectra Pro	12	83.3	8.3	8.3	103	8.8	e*
7	Fuji Dri-Chem	1057	99.1	0.9	0.1	101	6.2	e
8	Spotchem D-Concept	591	97.6	1.0	1.4	91	6.1	e
9	Spotchem SP-4430	72	90.3	6.9	2.8	80	9.2	e
10	Piccolo	51	98.0	0.0	2.0	103	6.8	e
11	Seamaty	11	100.0	0.0	0.0	86	6.5	e

Phosphatase alcaline 2

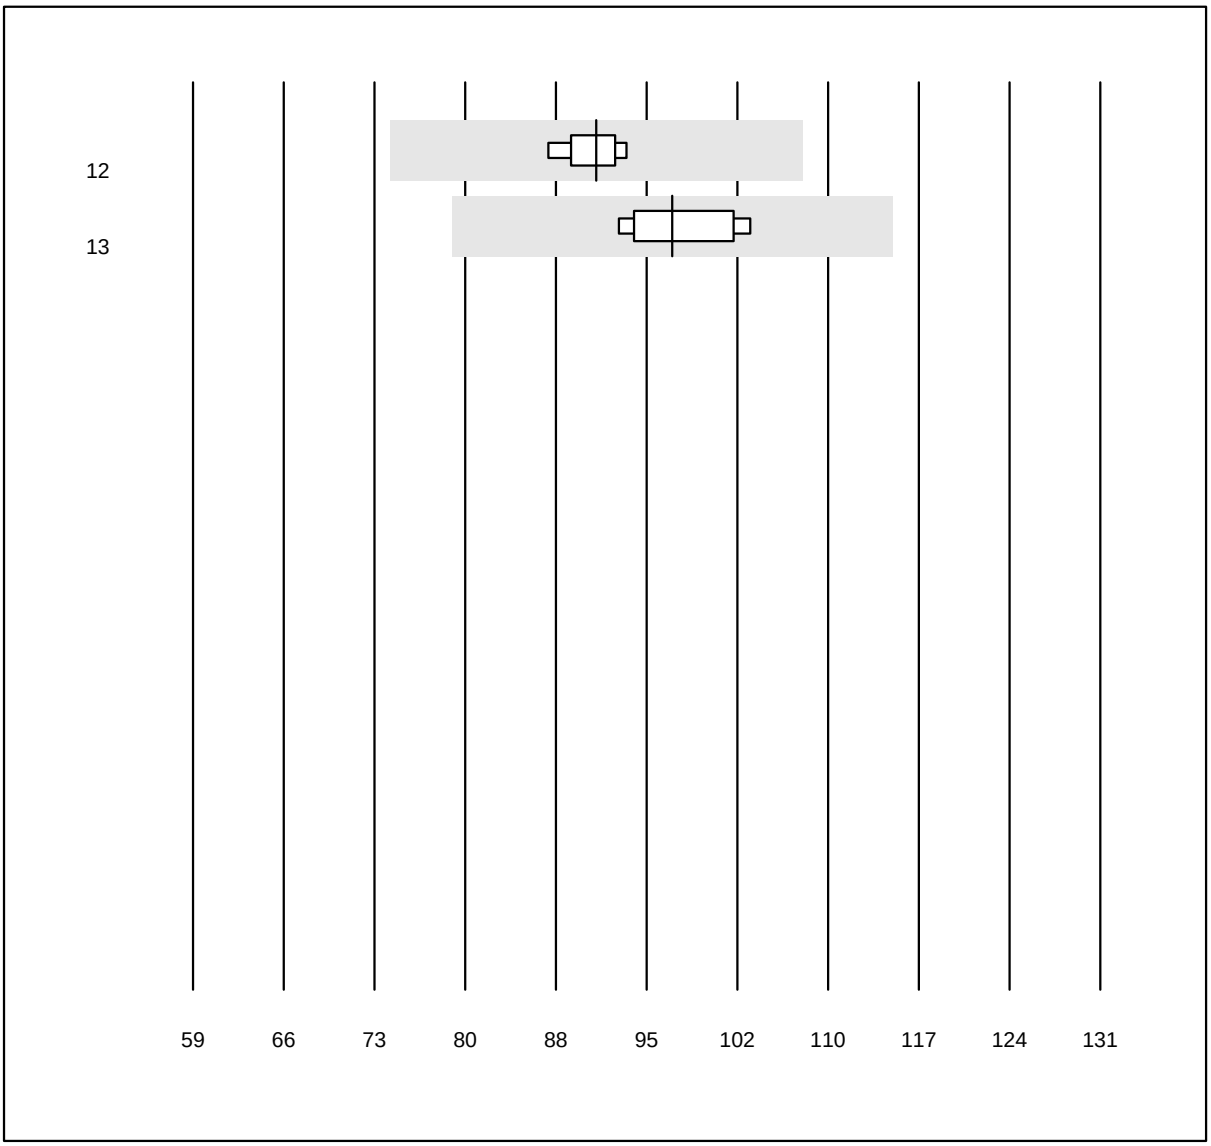


QUALAB Toleranz: 18%

Phosphatase alcaline (U/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
12	Skyla	5	100.0	0.0	0.0	91	2.1	e
13	Vitros	7	100.0	0.0	0.0	97	4.3	e

Amylase

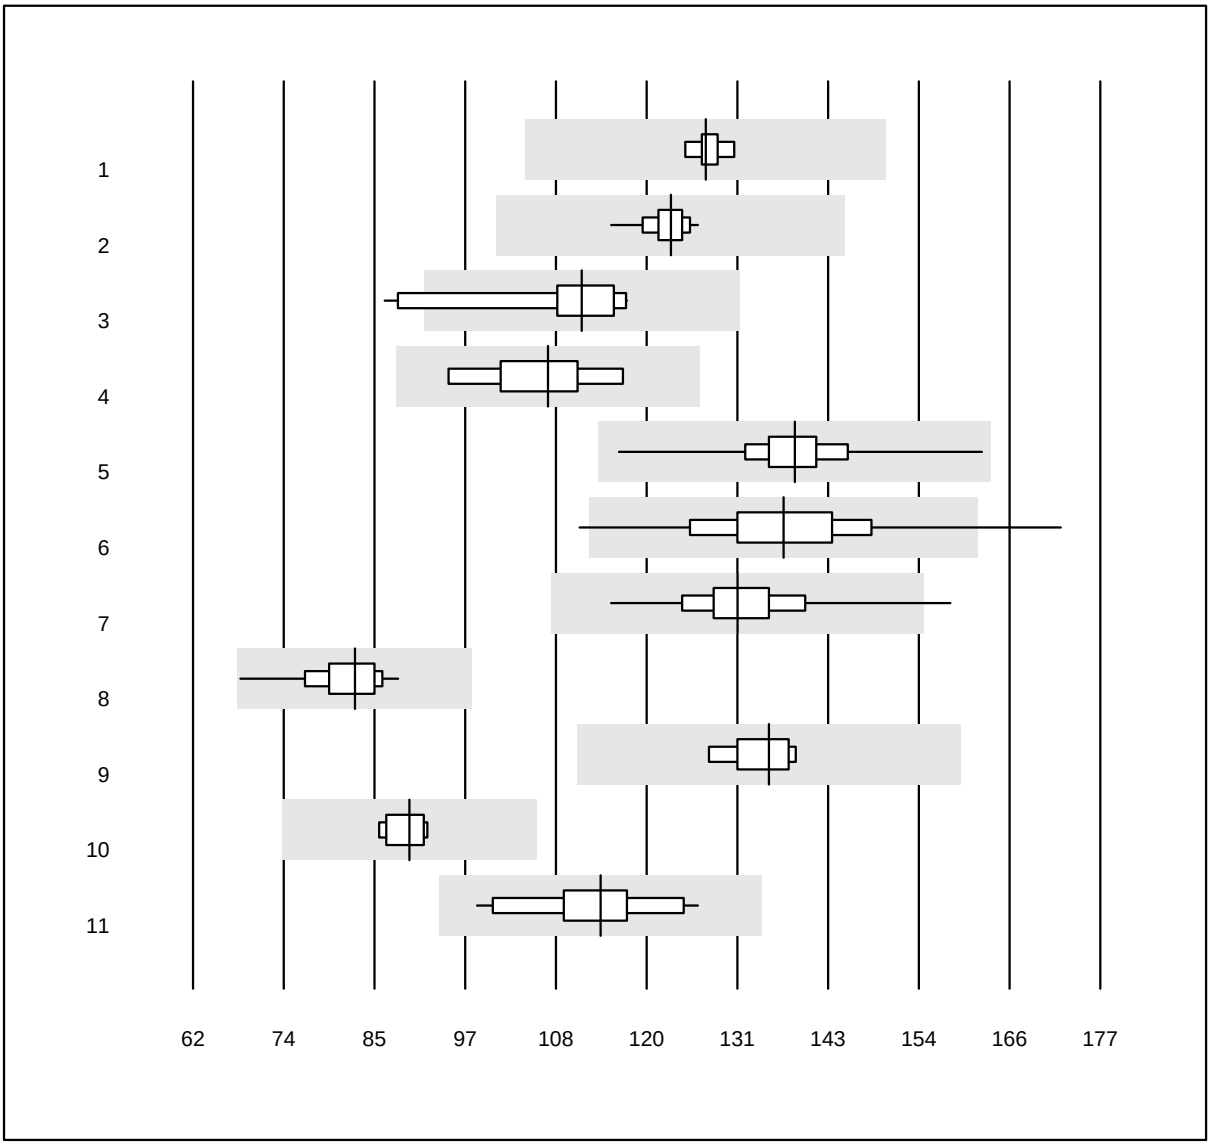


QUALAB Toleranz: 18%

Amylase (U/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	6	100.0	0.0	0.0	127	1.3	e
2	Roche	19	100.0	0.0	0.0	123	2.1	e
3	Autolyser	10	90.0	10.0	0.0	111	8.3	e*
4	Selectra Pro	8	100.0	0.0	0.0	107	6.3	e*
5	Fuji Dri-Chem	736	99.9	0.0	0.1	138	3.9	e
6	Spotchem D-Concept	404	98.5	1.2	0.2	137	6.7	e
7	Spotchem SP-4430	48	95.8	2.1	2.1	131	5.4	e
8	Piccolo	63	95.2	0.0	4.8	83	5.1	e
9	Beckman	5	100.0	0.0	0.0	135	2.7	e
10	Vitros	5	100.0	0.0	0.0	89	2.8	e
11	Seamaty	11	100.0	0.0	0.0	114	6.2	e

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Transaminase GOT/AST 1

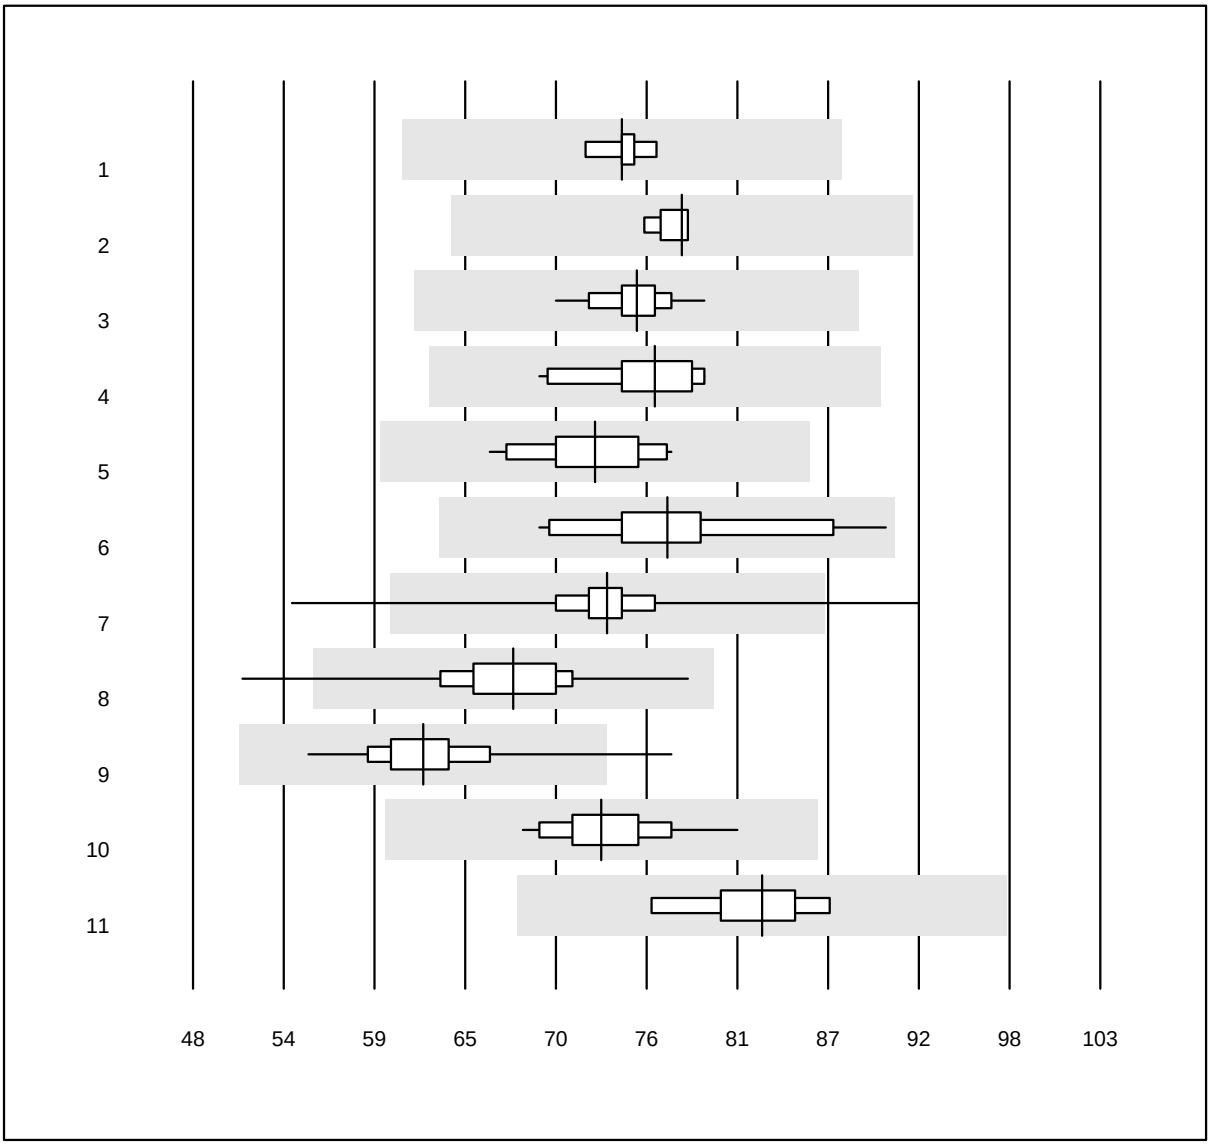


QUALAB Toleranz: 18%

Transaminase GOT/AST
(U/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	8	100.0	0.0	0.0	74	1.5	e
2	Beckman	5	100.0	0.0	0.0	78	1.3	e
3	Roche	49	100.0	0.0	0.0	75	2.6	e
4	Siemens	10	100.0	0.0	0.0	76	4.0	e
5	Autolyser	23	100.0	0.0	0.0	72	4.4	e
6	Selectra Pro	14	85.7	0.0	14.3	77	6.7	e
7	Fuji Dri-Chem	1168	99.1	0.4	0.4	73	3.7	e
8	Spotchem D-Concept	653	99.4	0.5	0.2	67	4.9	e
9	Spotchem SP-4430	125	99.2	0.8	0.0	62	5.3	e
10	Piccolo	74	98.6	0.0	1.4	73	4.1	e
11	Skyla	6	100.0	0.0	0.0	83	3.7	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Transaminase GOT/AST 2

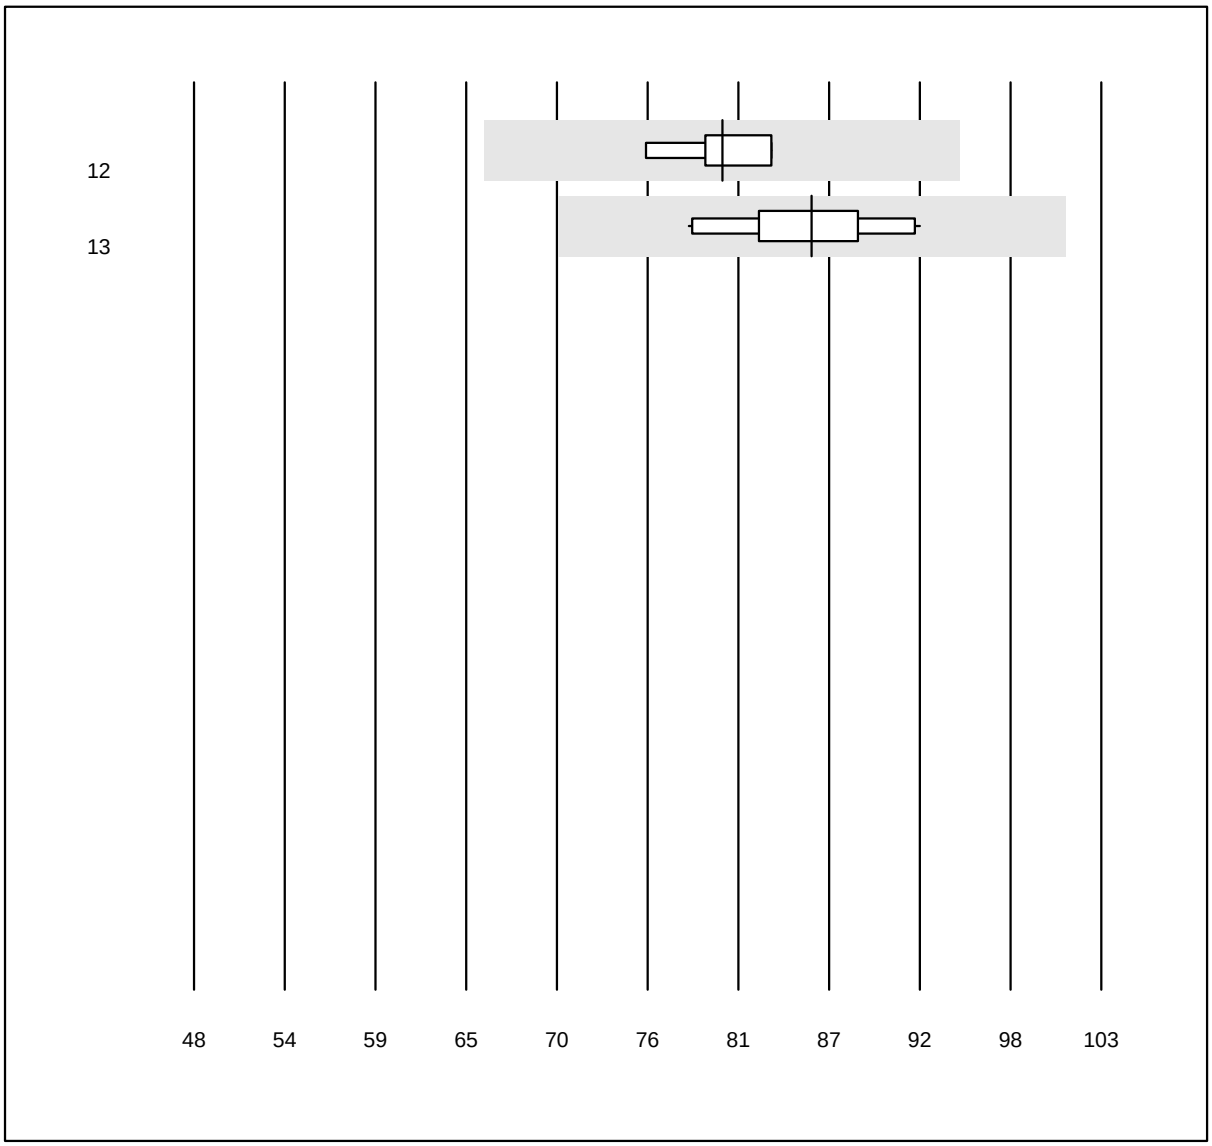


QUALAB Toleranz: 18%

Transaminase GOT/AST
(U/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
12	Vitros	7	100.0	0.0	0.0	80	3.1	e
13	Seamaty	10	100.0	0.0	0.0	85	4.9	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Bilirubine directe

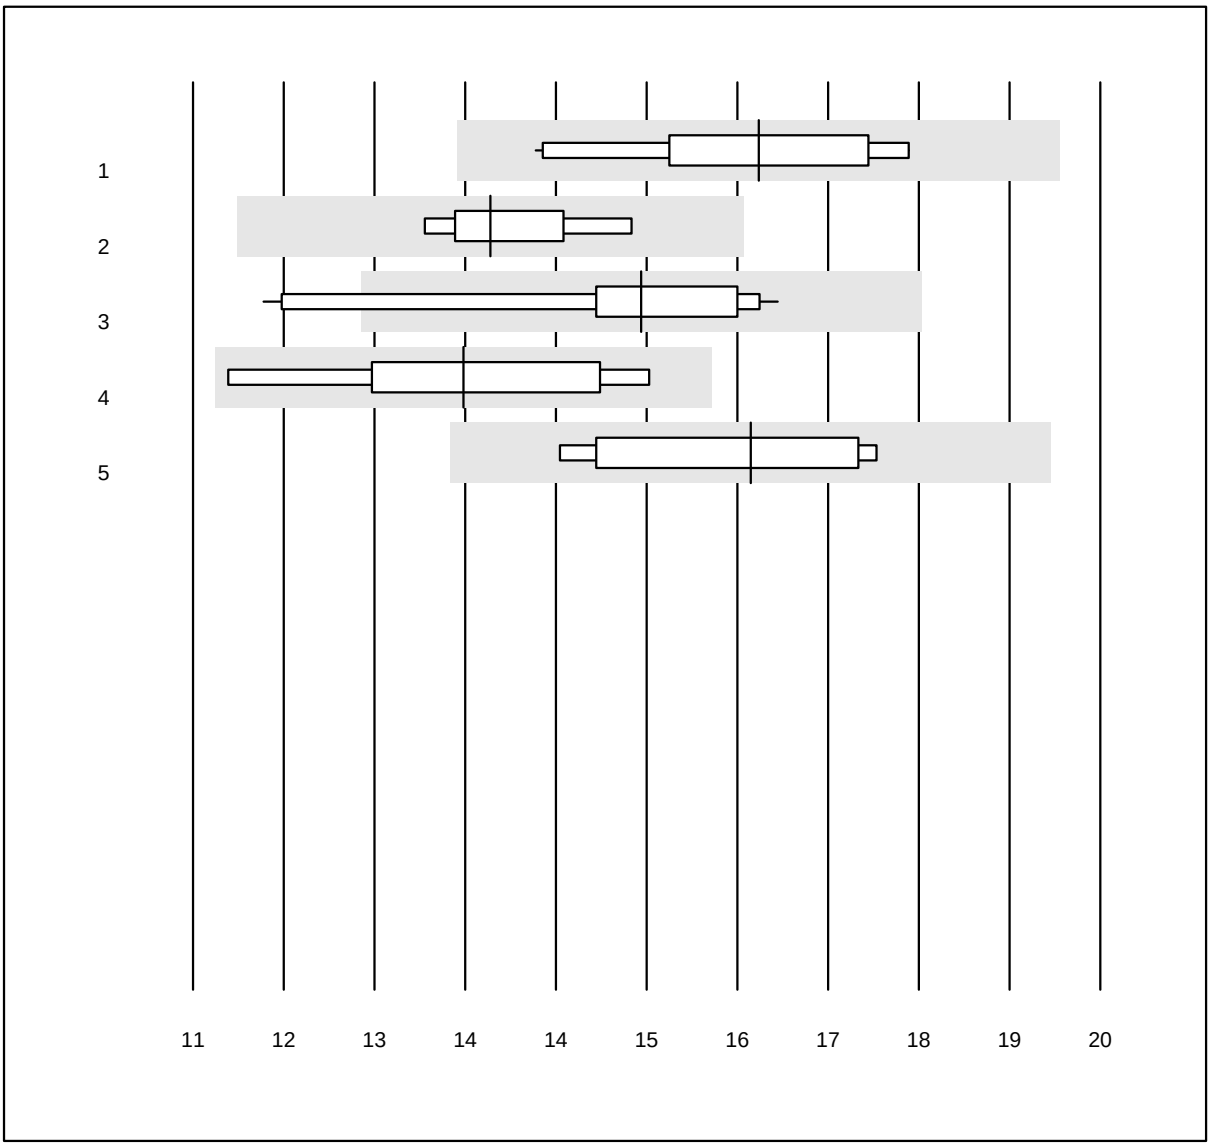


MQ Toleranz: 18%

Bilirubine directe (µmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	16	100.0	0.0	0.0	16.6	7.5	e
2	Siemens	4	100.0	0.0	0.0	13.9	4.2	e
3	Fuji Dri-Chem	15	80.0	20.0	0.0	15.4	11.3	e*
4	Vitros	5	80.0	0.0	20.0	13.7	8.9	e*
5	Autres méthodes	5	100.0	0.0	0.0	16.5	8.1	e*

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Bilirubine totale 1

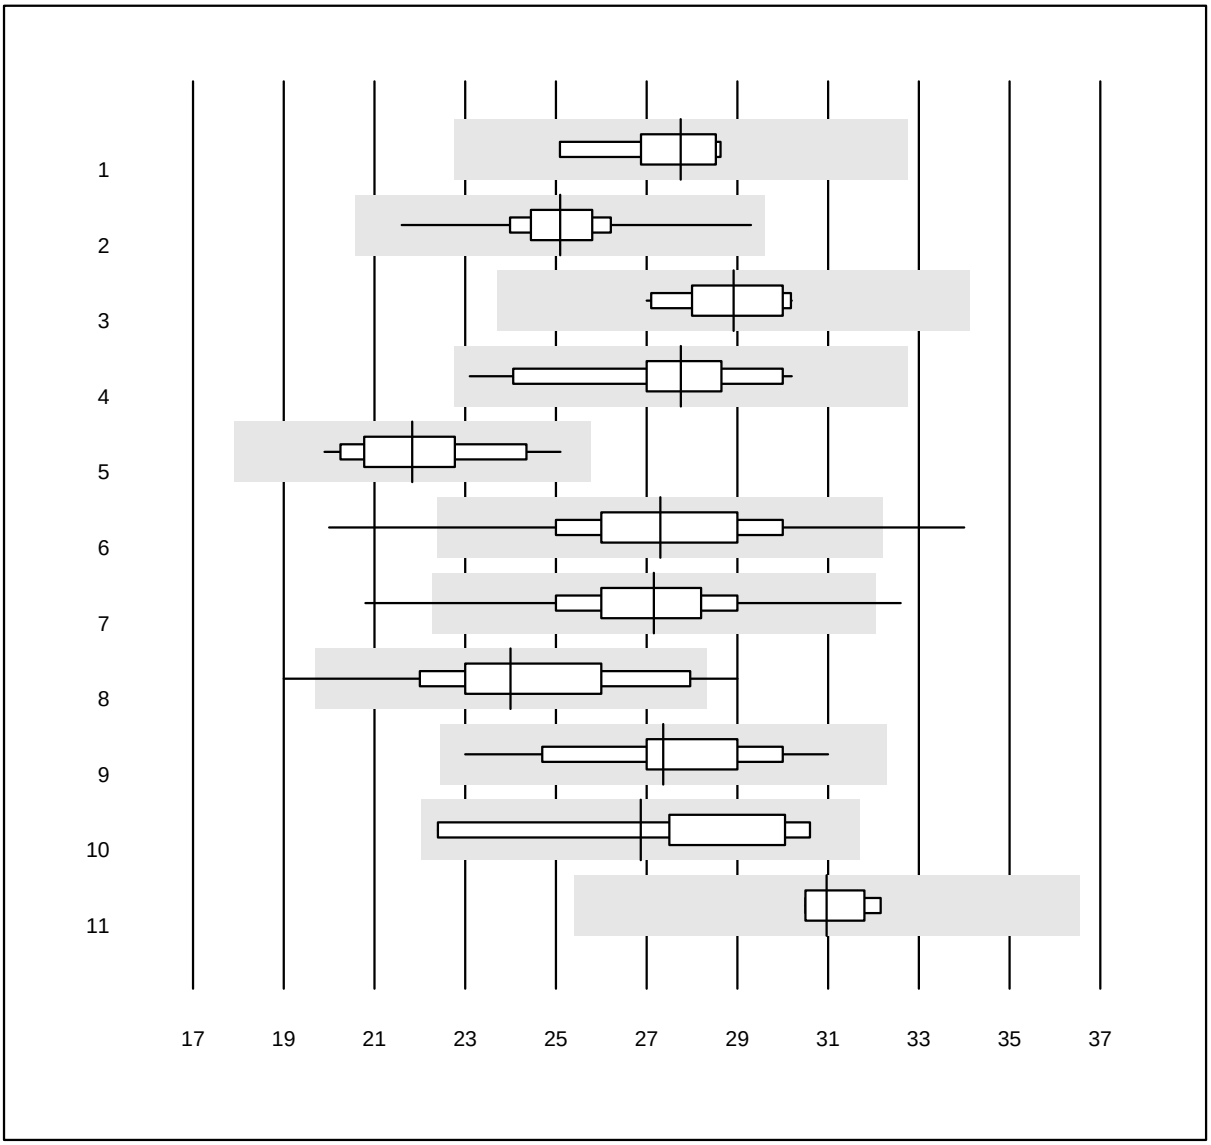


QUALAB Toleranz: 18%

Bilirubine totale (µmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	6	100.0	0.0	0.0	27.8	4.0	e
2	Roche	48	100.0	0.0	0.0	25.1	5.0	e
3	Siemens	10	100.0	0.0	0.0	28.9	3.7	e
4	Autolyser	21	100.0	0.0	0.0	27.8	7.2	e
5	Selectra Pro	14	100.0	0.0	0.0	21.8	6.4	e
6	Fuji Dri-Chem	878	96.1	2.3	1.6	27.3	7.7	e
7	Spotchem D-Concept	471	97.0	1.9	1.1	27.2	6.5	e
8	Spotchem SP-4430	64	92.2	6.2	1.6	24.0	9.8	e
9	Piccolo	61	91.8	0.0	8.2	27.4	7.5	e
10	Seamaty	11	81.8	0.0	18.2	26.9	8.9	e*
11	Beckman	5	100.0	0.0	0.0	31.0	2.2	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Bilirubine totale 2

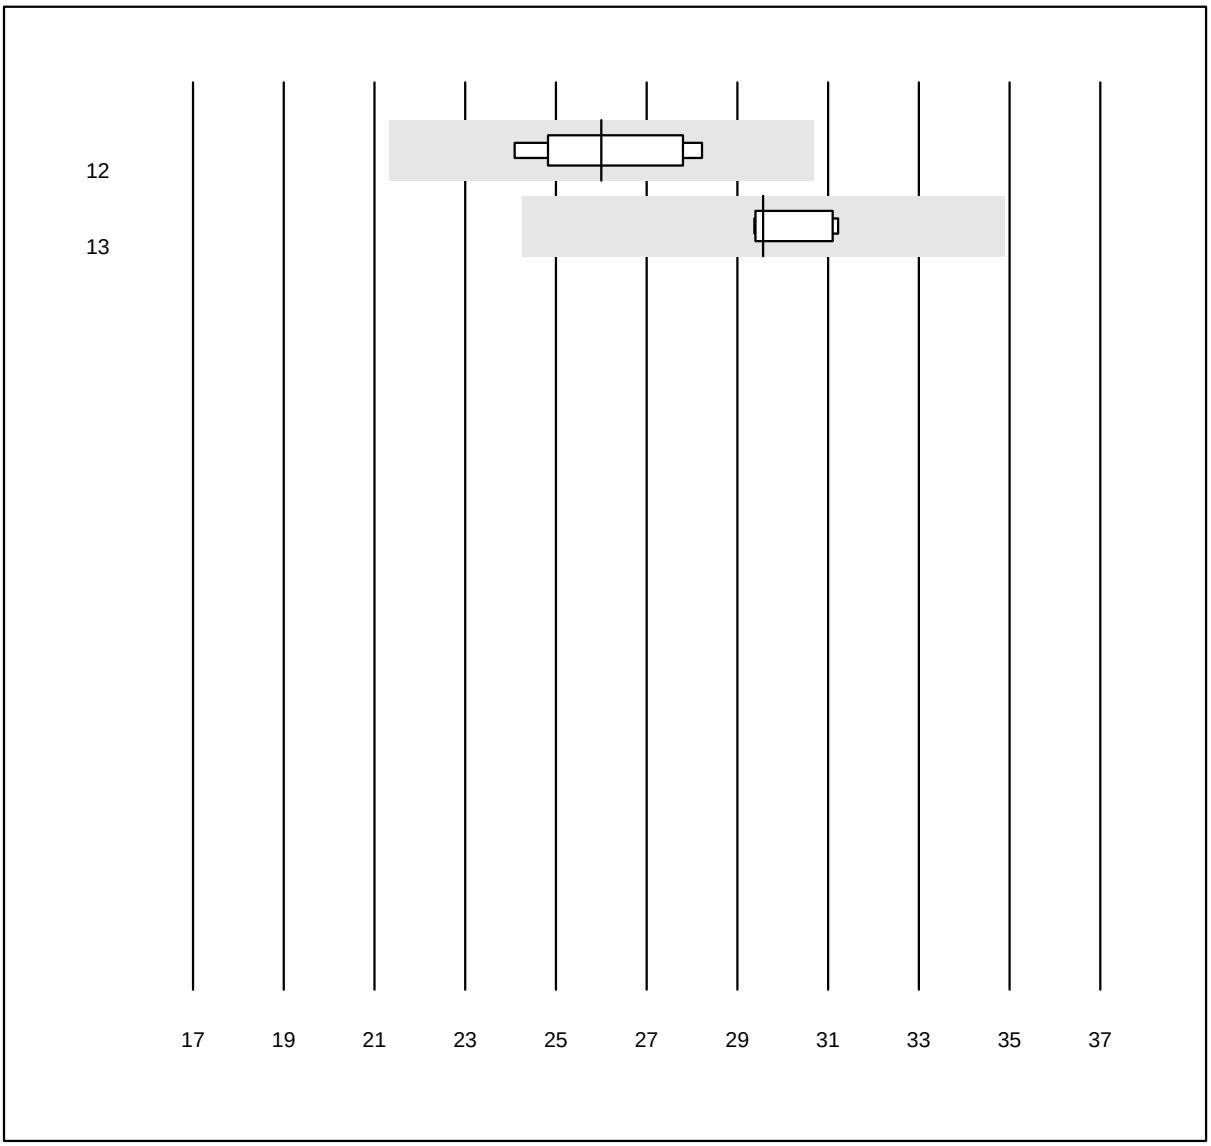


QUALAB Toleranz: 18%

Bilirubine totale (µmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
12	Skyla	6	100.0	0.0	0.0	26.0	6.2	e*
13	Vitros	7	100.0	0.0	0.0	29.6	2.7	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Calcium

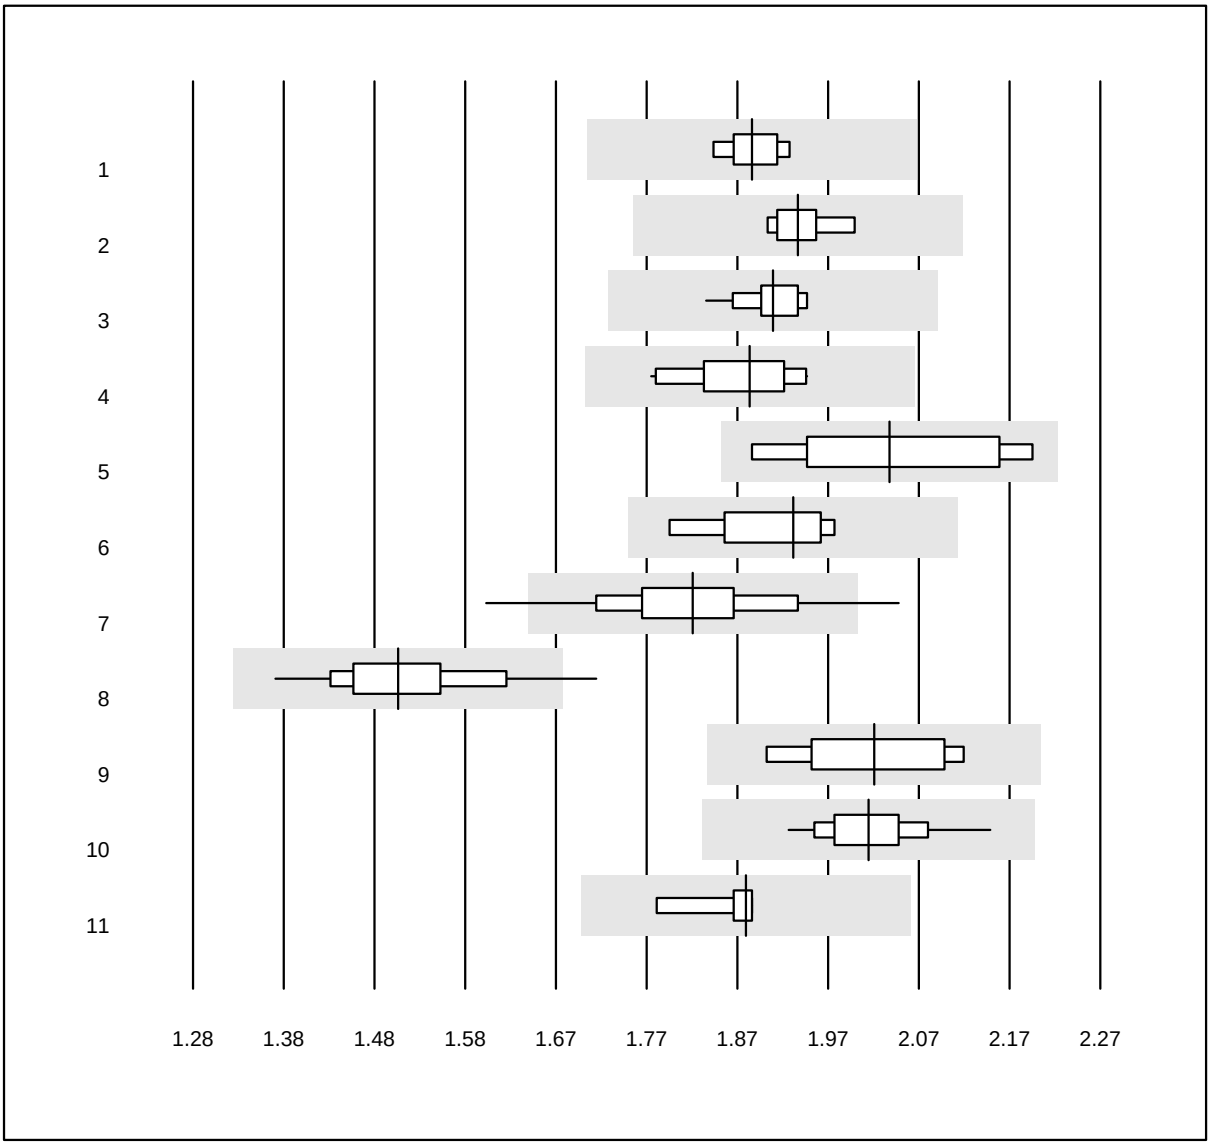


QUALAB Toleranz: 9%
(< 2.0: +/- 0.18 mmol/l)

Calcium (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	8	100.0	0.0	0.0	1.89	1.5	e
2	Beckman	6	100.0	0.0	0.0	1.94	1.4	e
3	Roche	48	100.0	0.0	0.0	1.91	1.5	e
4	Siemens	10	100.0	0.0	0.0	1.89	2.9	e
5	Autolyser	7	100.0	0.0	0.0	2.04	5.3	e*
6	Selectra Pro	4	100.0	0.0	0.0	1.94	3.0	e*
7	Fuji Dri-Chem	218	97.2	2.3	0.5	1.83	4.3	e
8	Spotchem D-Concept	58	96.6	1.7	1.7	1.50	4.9	e
9	Spotchem SP-4430	9	88.9	0.0	11.1	2.02	3.8	e*
10	Piccolo	49	95.9	0.0	4.1	2.02	2.3	e
11	Vitros	7	100.0	0.0	0.0	1.88	1.7	e

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Calcium ISE

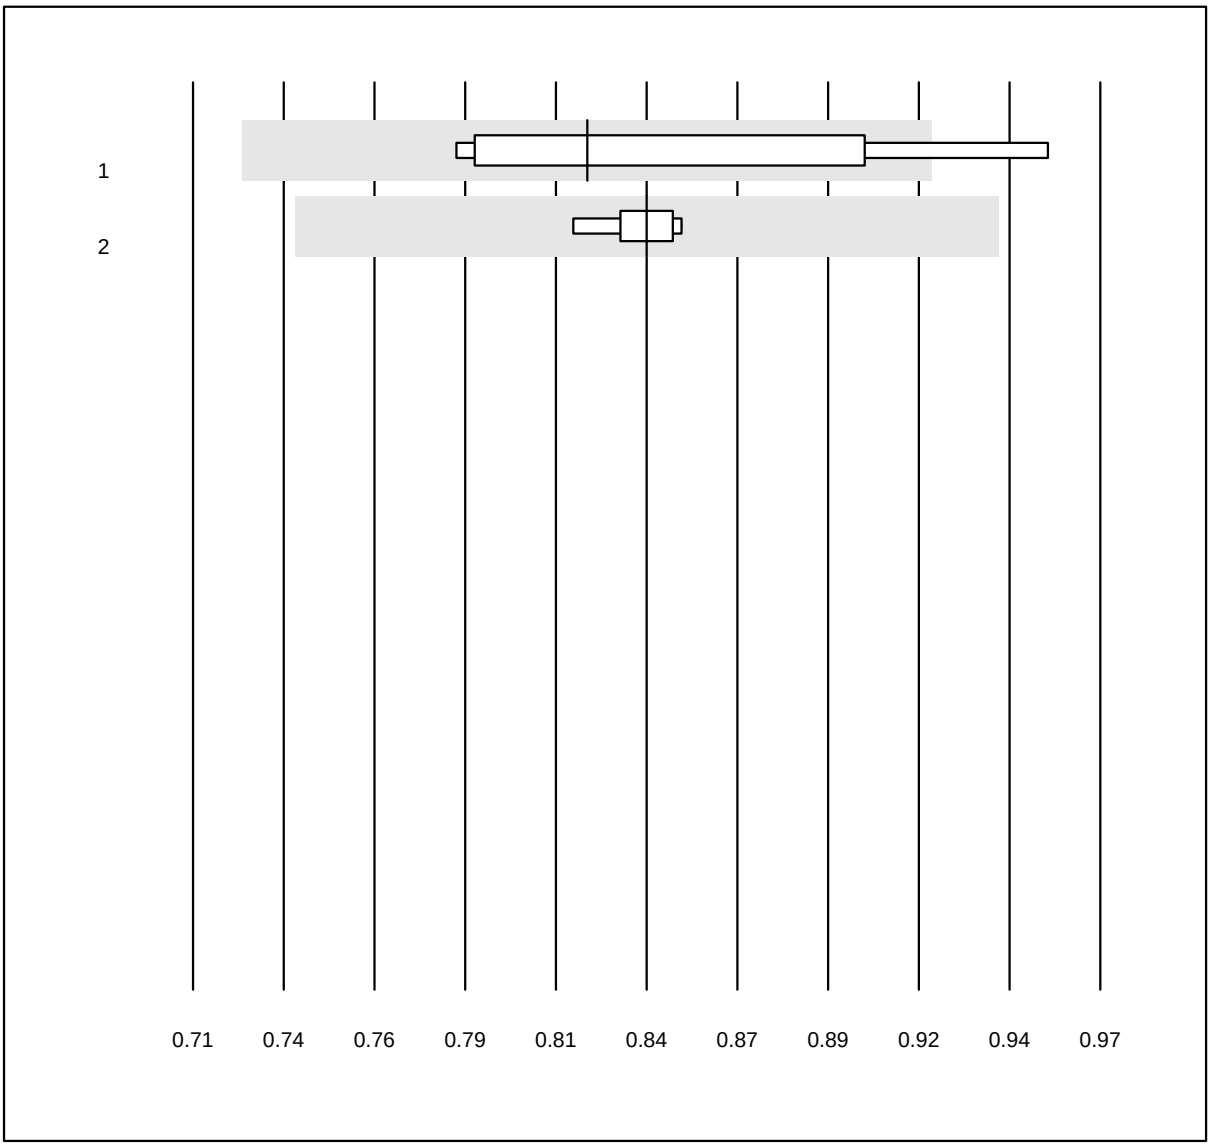


MQ Toleranz: 12%

Calcium ISE (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	ISE direct	4	100.0	0.0	0.0	0.82	7.2	e*
2	iStat Chem8	8	100.0	0.0	0.0	0.84	1.2	e

Chlorures

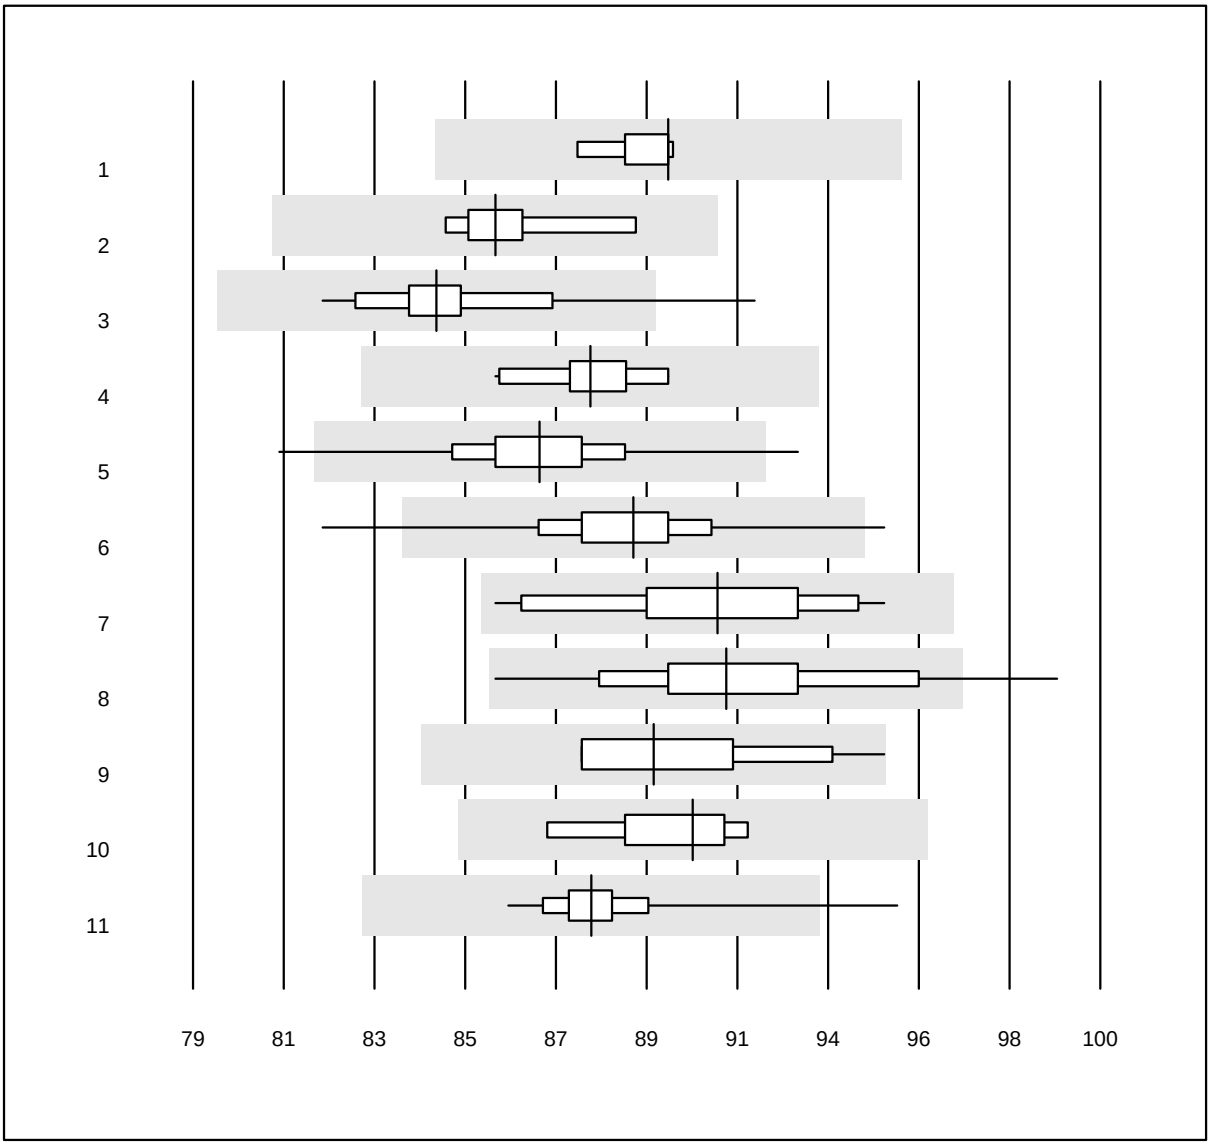


QUALAB Toleranz: 6%

Chlorures (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	8	100.0	0.0	0.0	90	0.9	e
2	Beckman	6	100.0	0.0	0.0	86	1.4	e
3	Roche	35	94.3	5.7	0.0	85	2.5	e
4	Siemens	10	100.0	0.0	0.0	88	1.4	e
5	Fuji Dri-Chem	964	98.4	0.6	0.9	87	1.8	e
6	Spotchem D-Concept	402	96.3	1.5	2.2	89	2.0	e
7	Piccolo	25	100.0	0.0	0.0	91	2.8	e
8	Spotchem EL-SE 1520	43	90.7	9.3	0.0	91	3.0	e
9	iStat Chem8	13	100.0	0.0	0.0	90	2.4	e
10	Vitros	5	100.0	0.0	0.0	91	1.5	e
11	Exias	96	96.9	2.1	1.0	88	1.5	e

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Cholestérol 1

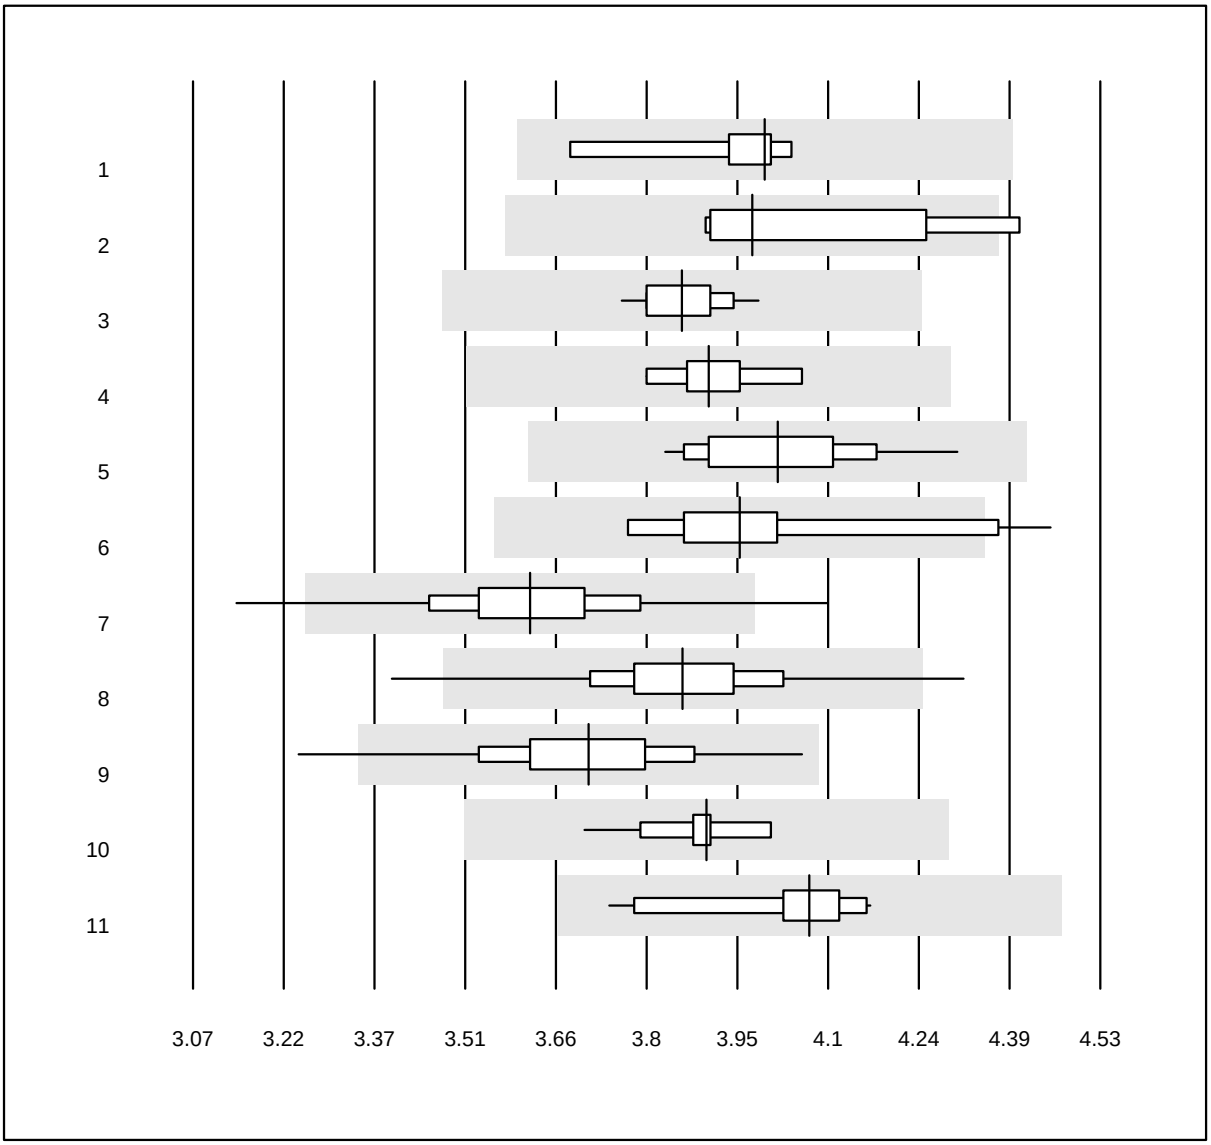


QUALAB Toleranz: 10%

Cholestérol (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	8	100.0	0.0	0.0	3.99	2.7	e
2	Beckman	5	80.0	0.0	20.0	3.97	4.7	e*
3	Roche	38	100.0	0.0	0.0	3.86	1.5	e
4	Siemens	9	100.0	0.0	0.0	3.90	2.0	e
5	Autolyser	22	100.0	0.0	0.0	4.01	3.0	e
6	Selectra Pro	12	83.3	8.3	8.3	3.95	4.7	e*
7	Fuji Dri-Chem	1005	97.1	0.9	2.0	3.61	3.7	e
8	Spotchem D-Concept	506	97.6	0.8	1.6	3.86	3.3	e
9	Spotchem SP-4430	72	98.6	1.4	0.0	3.71	3.8	e
10	Piccolo	20	90.0	0.0	10.0	3.90	2.0	e
11	Seamaty	11	100.0	0.0	0.0	4.06	2.9	e

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Cholestérol 2

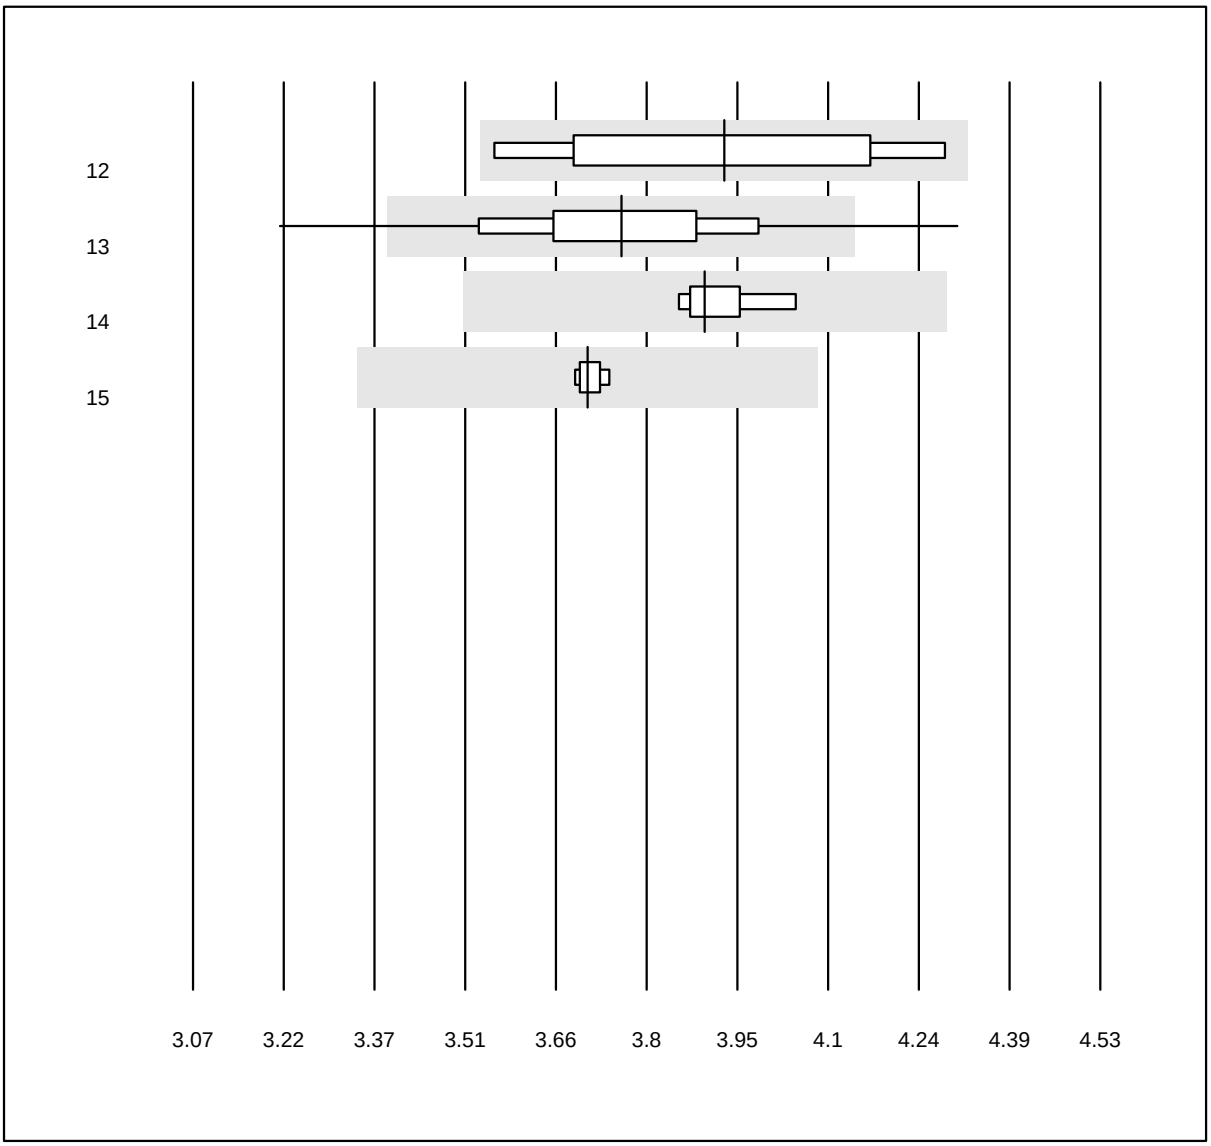


QUALAB Toleranz: 10%

Cholestérol (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
12	Skyla	4	100.0	0.0	0.0	3.92	6.3	e*
13	Cholestech LDX	198	94.4	4.0	1.5	3.76	4.8	e
14	Vitros	5	100.0	0.0	0.0	3.89	1.4	e
15	Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	3.71	0.5	e

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

HDL-Cholestérol 1

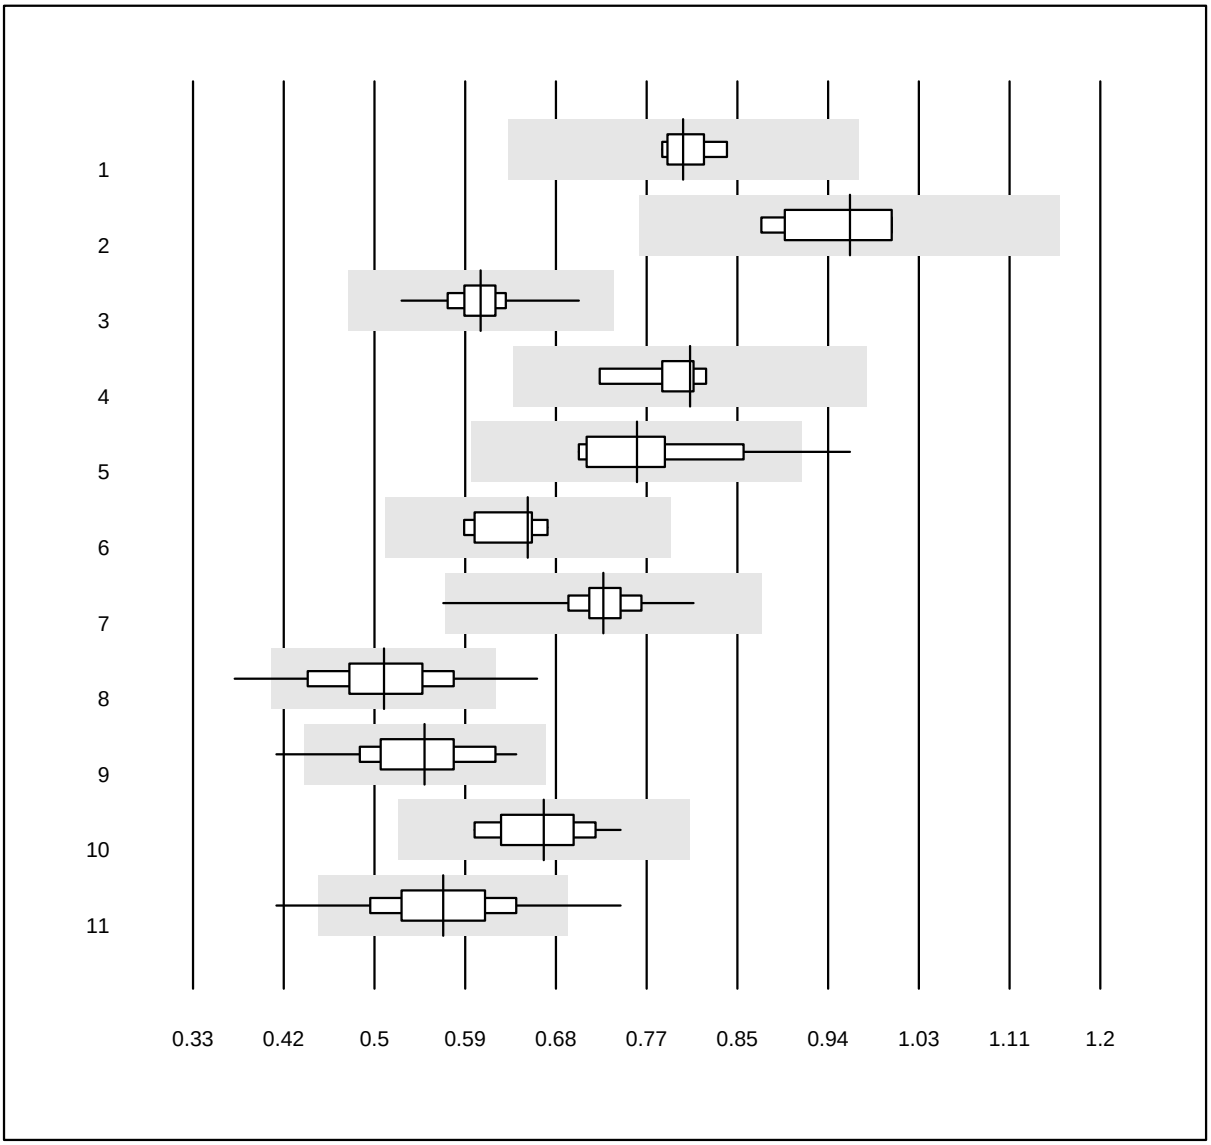


QUALAB Toleranz: 21%

HDL-Cholestérol (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	8	100.0	0.0	0.0	0.80	2.6	e
2	Beckman	4	100.0	0.0	0.0	0.96	5.9	e*
3	Roche	37	97.3	0.0	2.7	0.61	4.5	e
4	Siemens	7	100.0	0.0	0.0	0.81	3.9	e
5	Autolyser	23	91.3	4.3	4.3	0.76	8.5	e
6	Selectra Pro	11	81.8	0.0	18.2	0.65	4.6	e
7	Fuji Dri-Chem	980	99.5	0.1	0.4	0.72	4.0	e
8	Spotchem D-Concept	495	94.7	3.2	2.0	0.51	10.2	e
9	Spotchem SP-4430	66	95.5	1.5	3.0	0.55	8.6	e
10	Piccolo	18	94.4	0.0	5.6	0.67	6.1	e
11	Cholestech LDX	199	91.0	7.5	1.5	0.57	10.6	e

3 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

HDL-Cholestérol 2

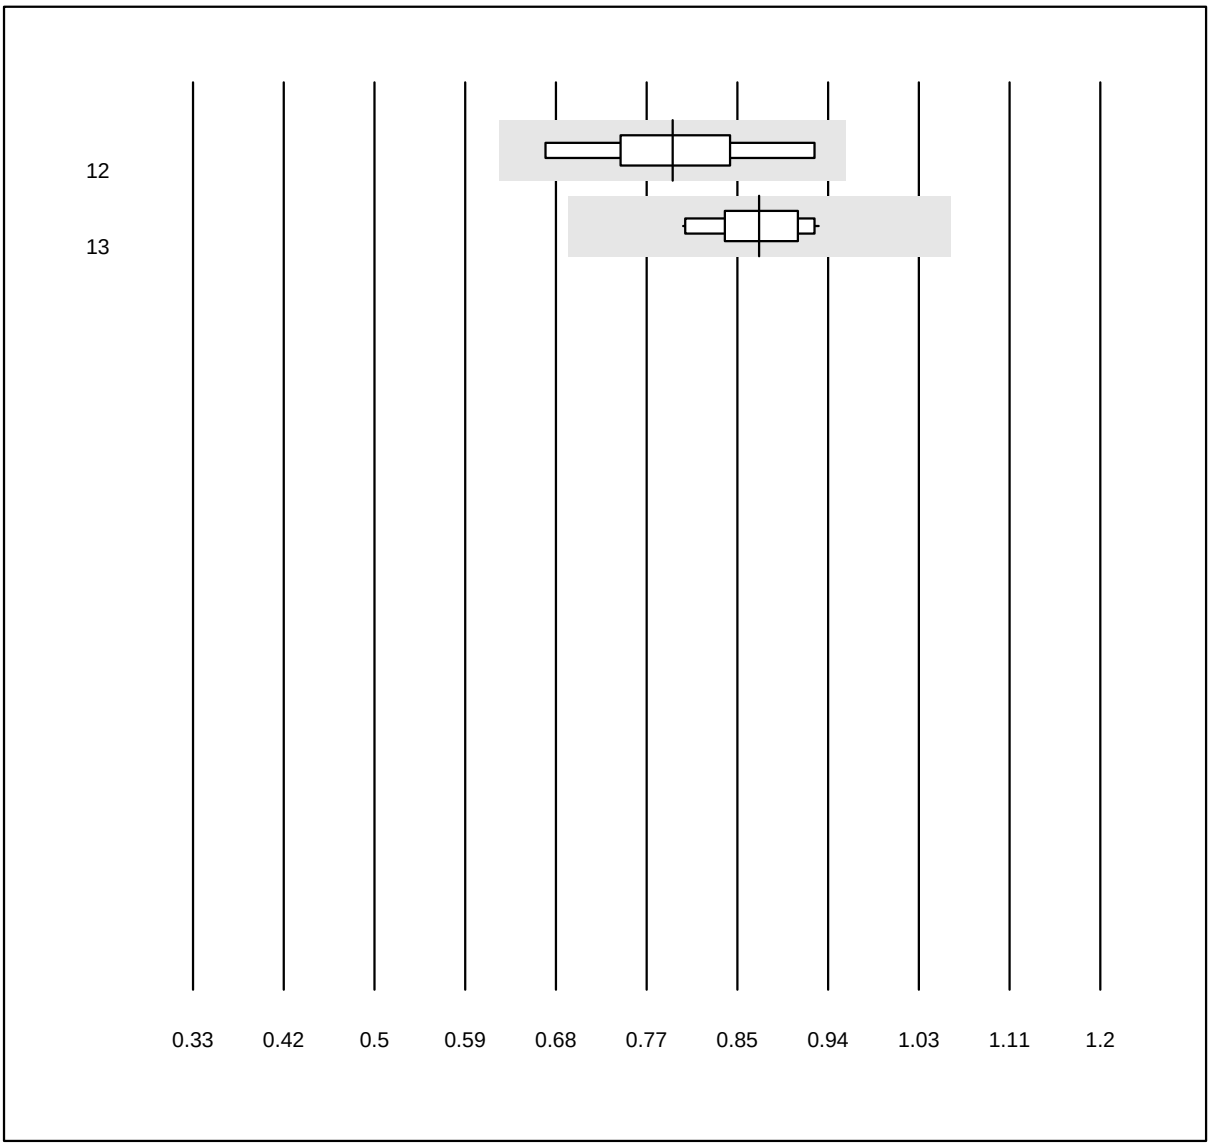


QUALAB Toleranz: 21%

HDL-Cholestérol (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
12	Vitros	5	100.0	0.0	0.0	0.79	8.5	e*
13	Seamaty	11	100.0	0.0	0.0	0.87	4.9	e

3 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

eGFR CKD-EPI

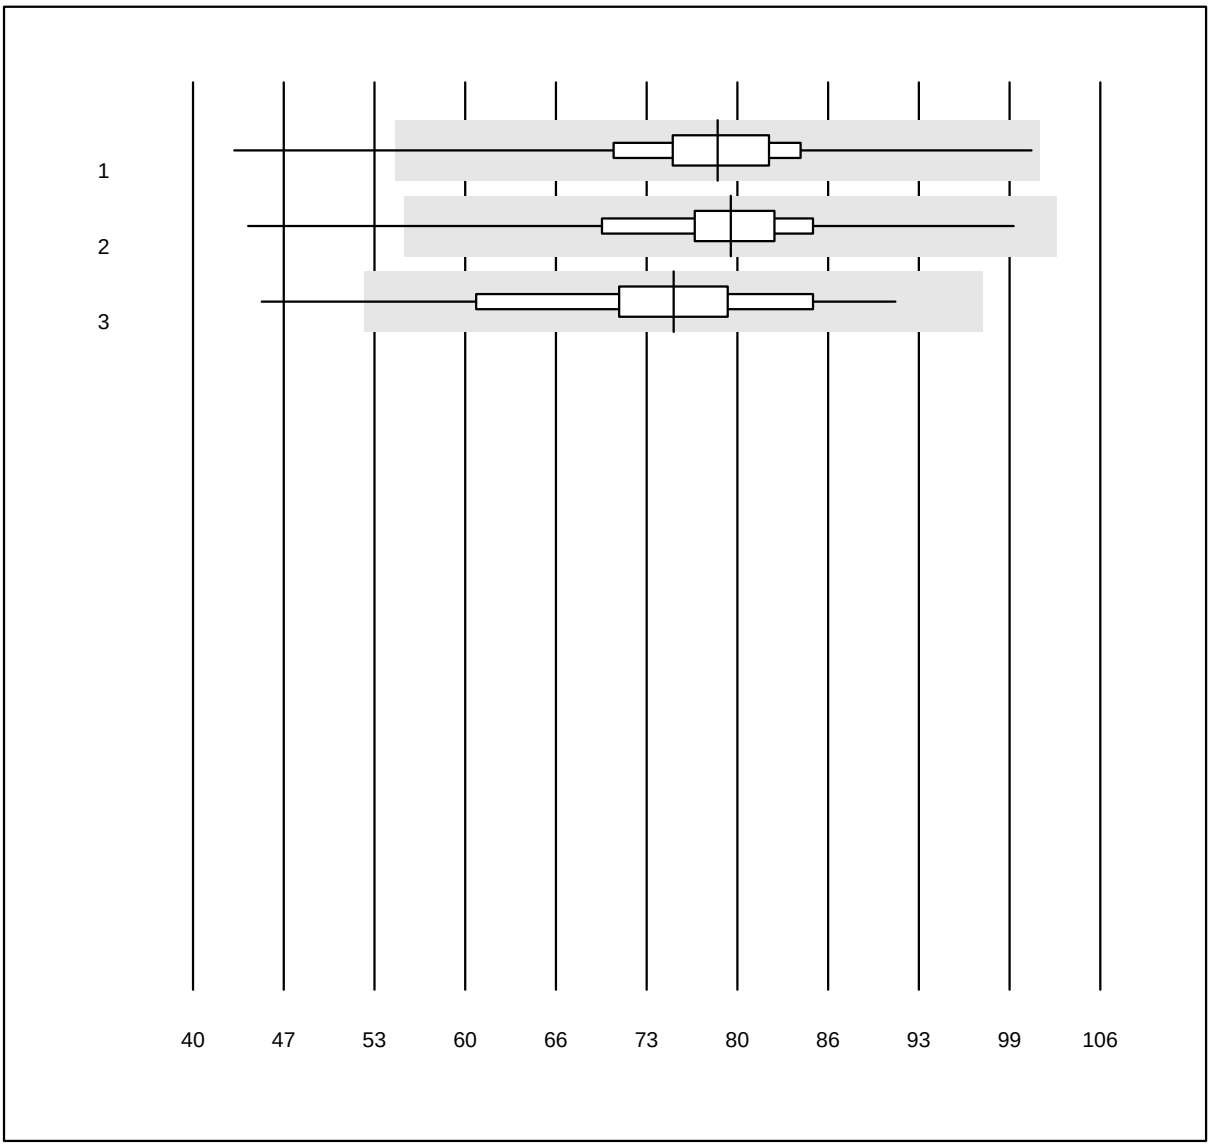


QUALAB Toleranz: 30%

eGFR CKD-EPI ()

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Fuji Dri-Chem	425	95.8	2.8	1.4	78.2	10.0	e
2	Spotchem	286	95.8	1.7	2.4	79.1	9.4	e
3	Chimie humide	59	96.6	3.4	0.0	75.0	12.0	e

eGFR Cockcroft-Gault

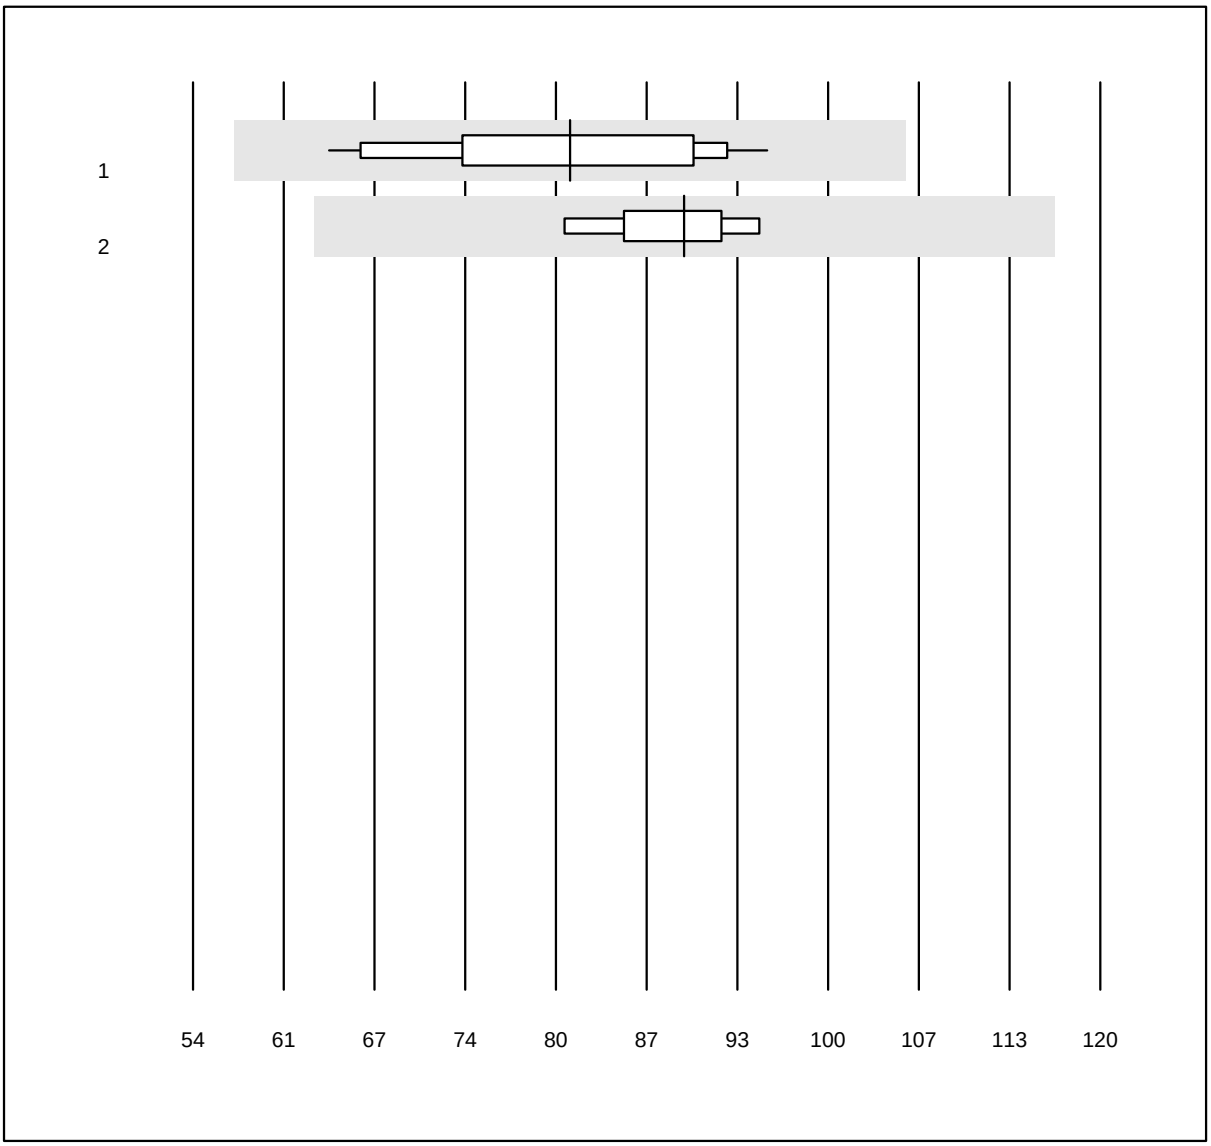


MQ Toleranz: 30%

eGFR Cockcroft-Gault ()

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Fuji Dri-Chem	21	100.0	0.0	0.0	81	11.4	e
2	Spotchem	8	100.0	0.0	0.0	90	5.0	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

eGFR MDRD

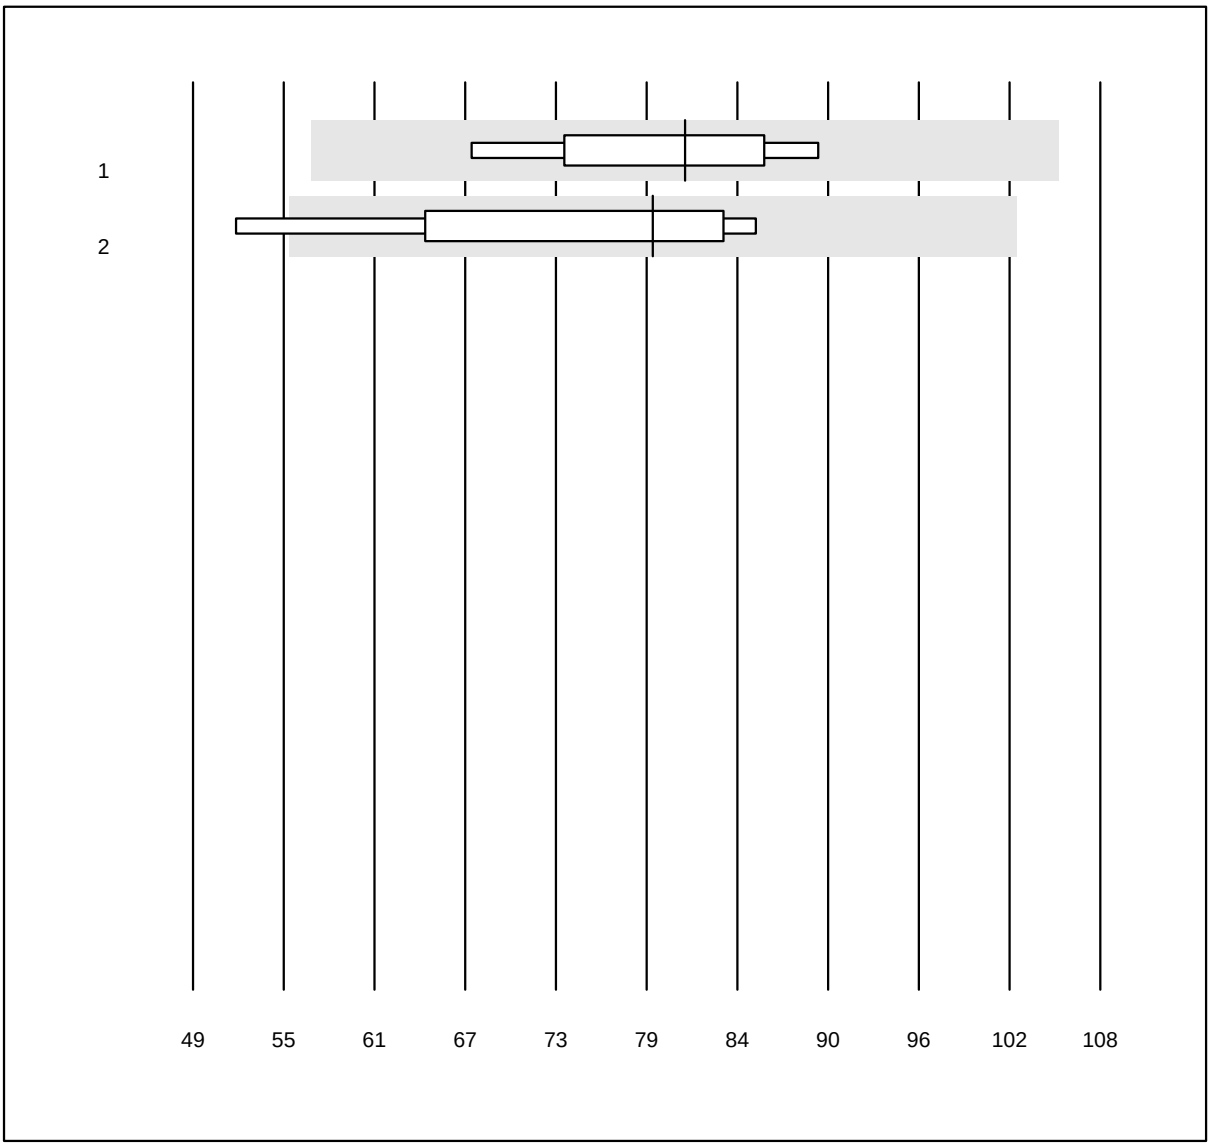


MQ Toleranz: 30%

eGFR MDRD ()

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Fuji Dri-Chem	5	100.0	0.0	0.0	81	8.9	e*
2	Chimie humide	4	100.0	0.0	0.0	79	14.3	e*

Fer

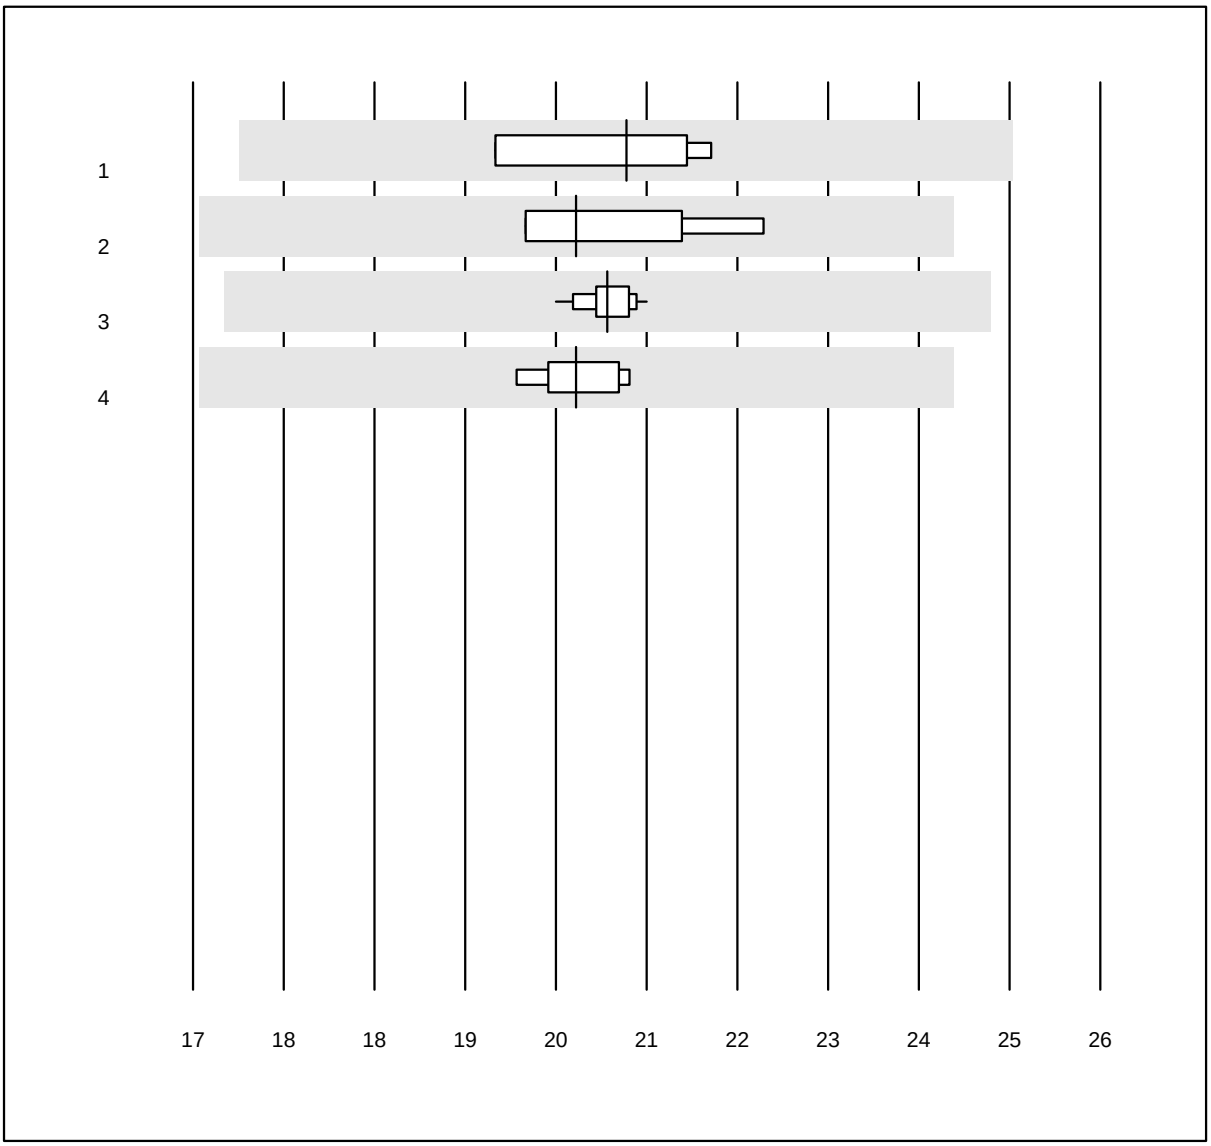


QUALAB Toleranz: 18%

Fer (µmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	7	100.0	0.0	0.0	21	4.0	e
2	Beckman	5	100.0	0.0	0.0	21	4.1	e
3	Roche	26	100.0	0.0	0.0	21	1.1	e
4	Siemens	6	100.0	0.0	0.0	21	1.8	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Gamma-GT 1

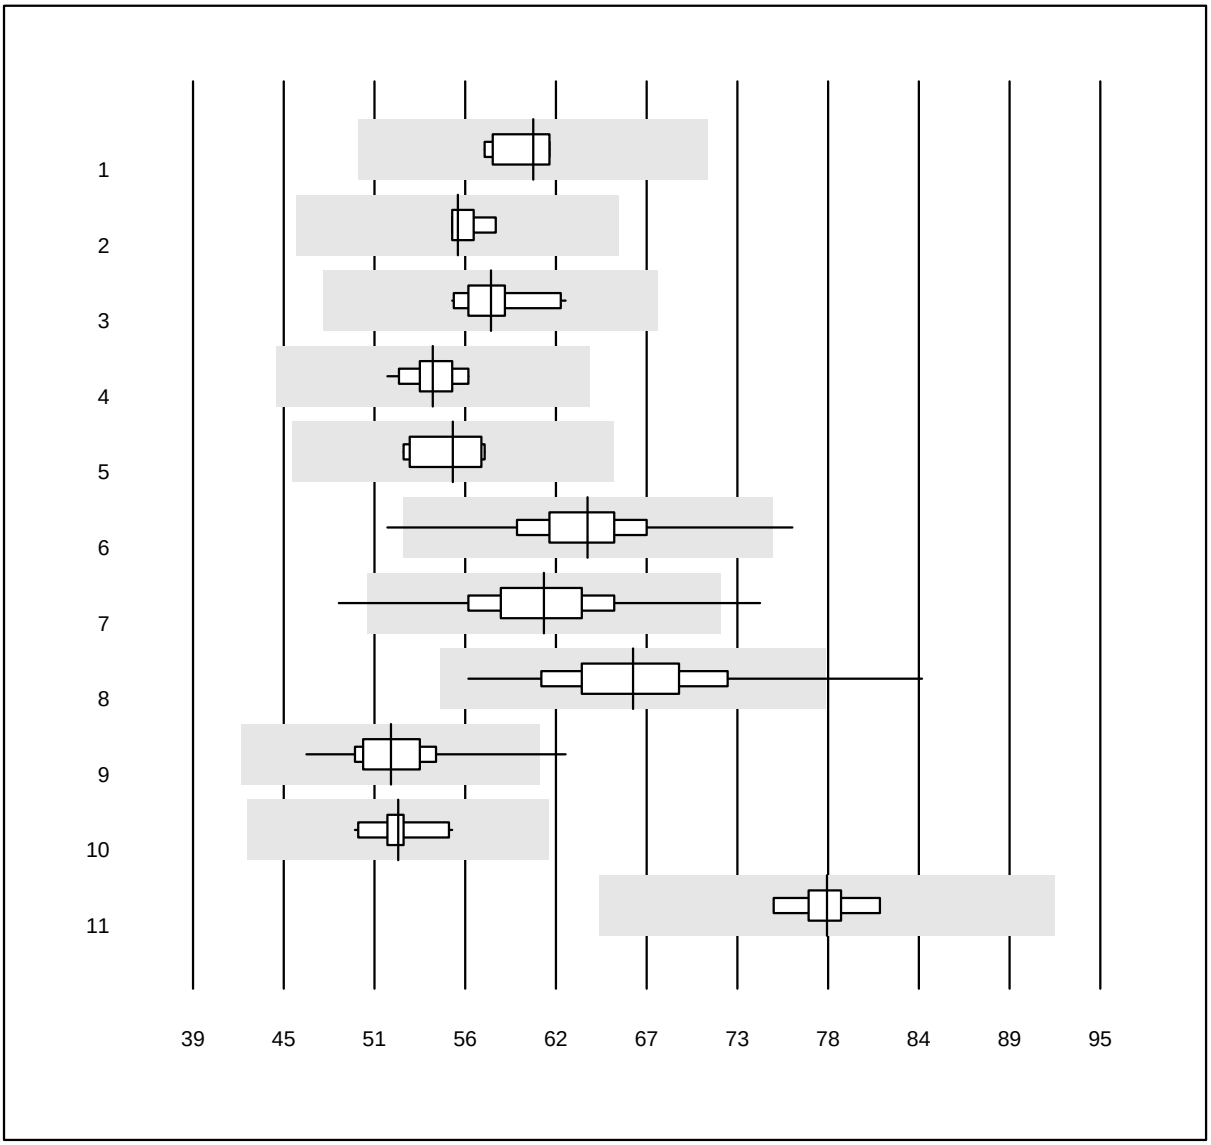


QUALAB Toleranz: 18%

Gamma-GT (U/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	8	100.0	0.0	0.0	60	2.8	e
2	Beckman	6	100.0	0.0	0.0	55	1.6	e
3	Siemens	10	100.0	0.0	0.0	57	3.4	e
4	Autolyser	23	100.0	0.0	0.0	54	2.9	e
5	Selectra Pro	13	92.3	0.0	7.7	55	3.7	e
6	Fuji Dri-Chem	1167	99.4	0.2	0.4	63	4.9	e
7	Spotchem D-Concept	654	99.5	0.3	0.2	61	5.5	e
8	Spotchem SP-4430	115	97.4	1.7	0.9	66	7.4	e
9	Piccolo	57	96.5	3.5	0.0	51	5.3	e
10	Seamaty	11	100.0	0.0	0.0	52	3.2	e
11	Vitros	7	100.0	0.0	0.0	78	2.3	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Gamma-GT 2

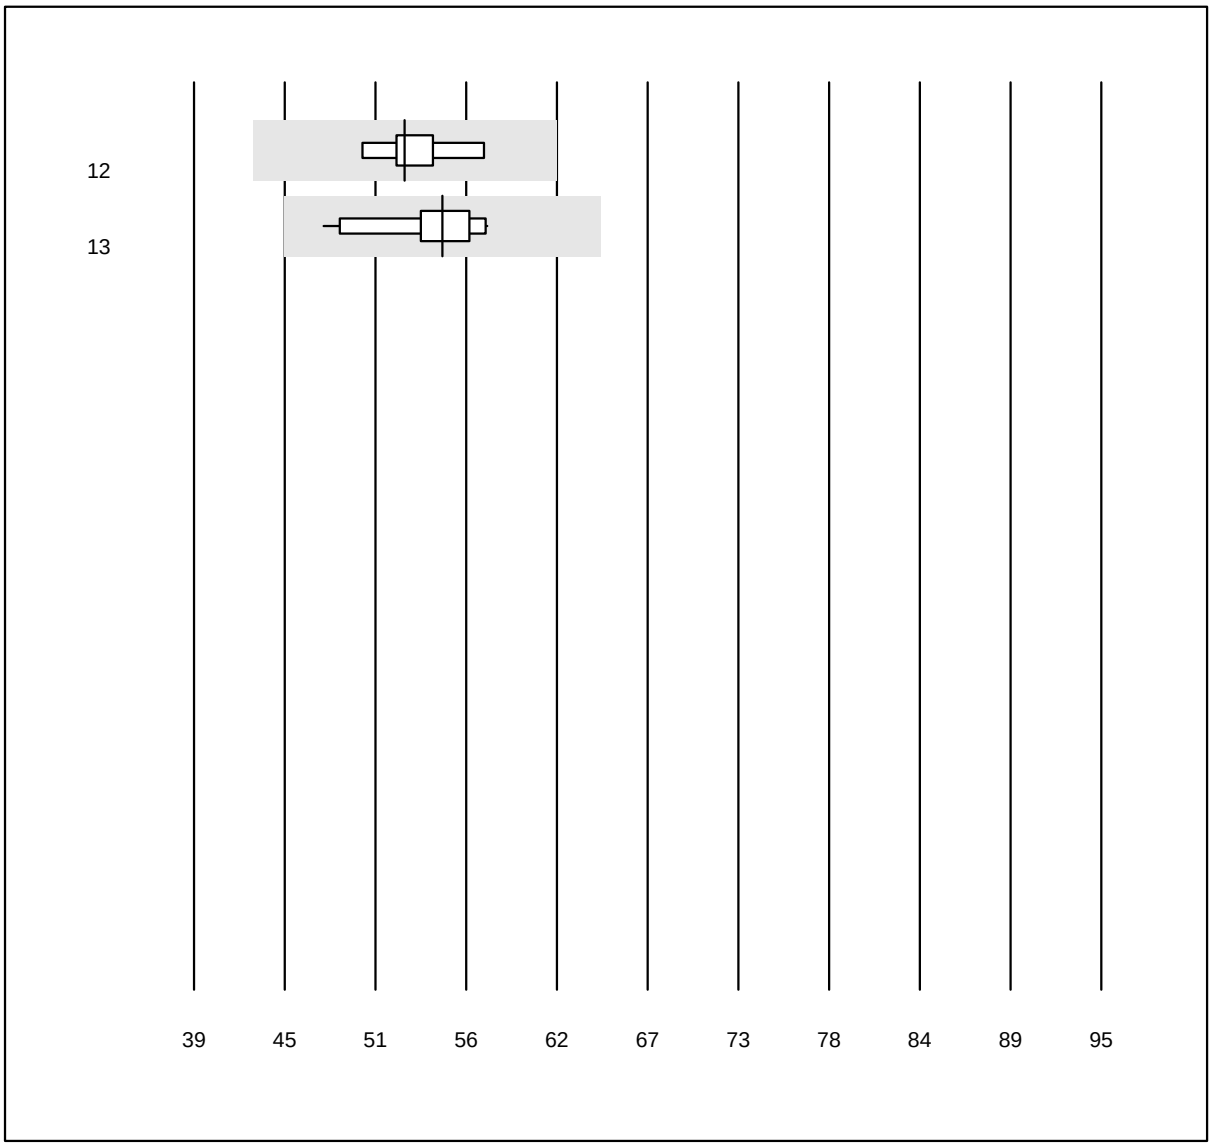


QUALAB Toleranz: 18%

Gamma-GT (U/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
12	Skyla	6	100.0	0.0	0.0	52	3.8	e
13	Cobas	48	100.0	0.0	0.0	54	5.6	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Glucose 1

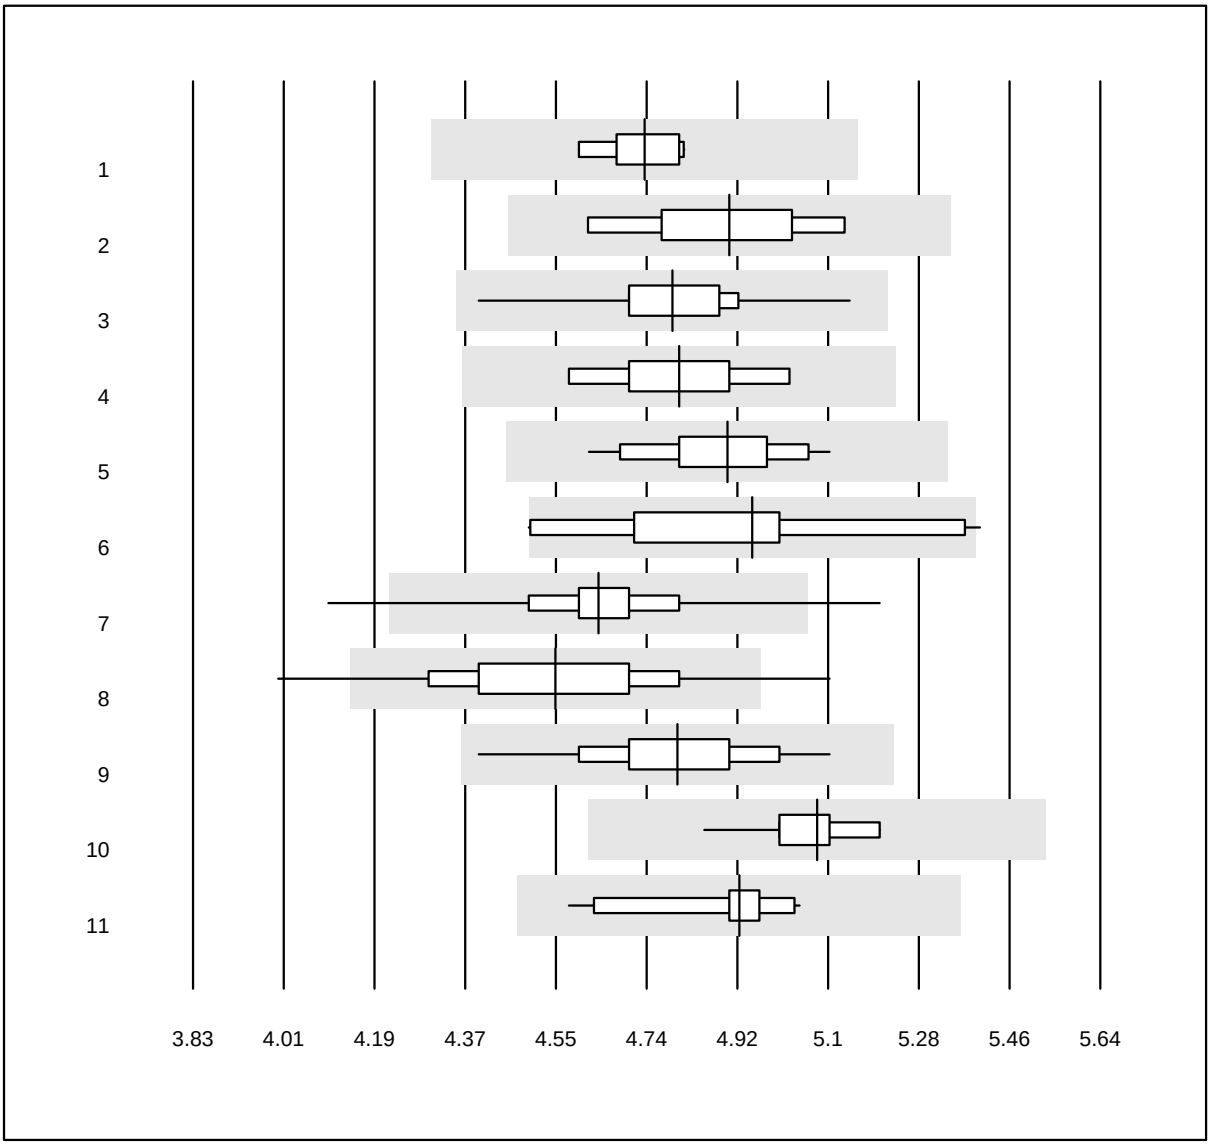


QUALAB Toleranz: 9%

Glucose (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	10	100.0	0.0	0.0	4.7	1.8	e
2	Beckman	6	100.0	0.0	0.0	4.9	3.1	e*
3	Roche	51	100.0	0.0	0.0	4.8	2.4	e
4	Siemens	7	100.0	0.0	0.0	4.8	2.9	e*
5	Autolyser	21	95.2	0.0	4.8	4.9	2.7	e
6	Selectra Pro	13	76.9	15.4	7.7	4.9	5.6	e*
7	Fuji Dri-Chem	1112	98.6	0.9	0.5	4.6	2.7	e
8	Spotchem D-Concept	616	96.6	2.9	0.5	4.6	3.9	e
9	Spotchem SP-4430	90	97.8	0.0	2.2	4.8	3.3	e
10	Piccolo	71	100.0	0.0	0.0	5.1	1.5	e
11	Seamaty	11	100.0	0.0	0.0	4.9	2.4	e

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Glucose 2

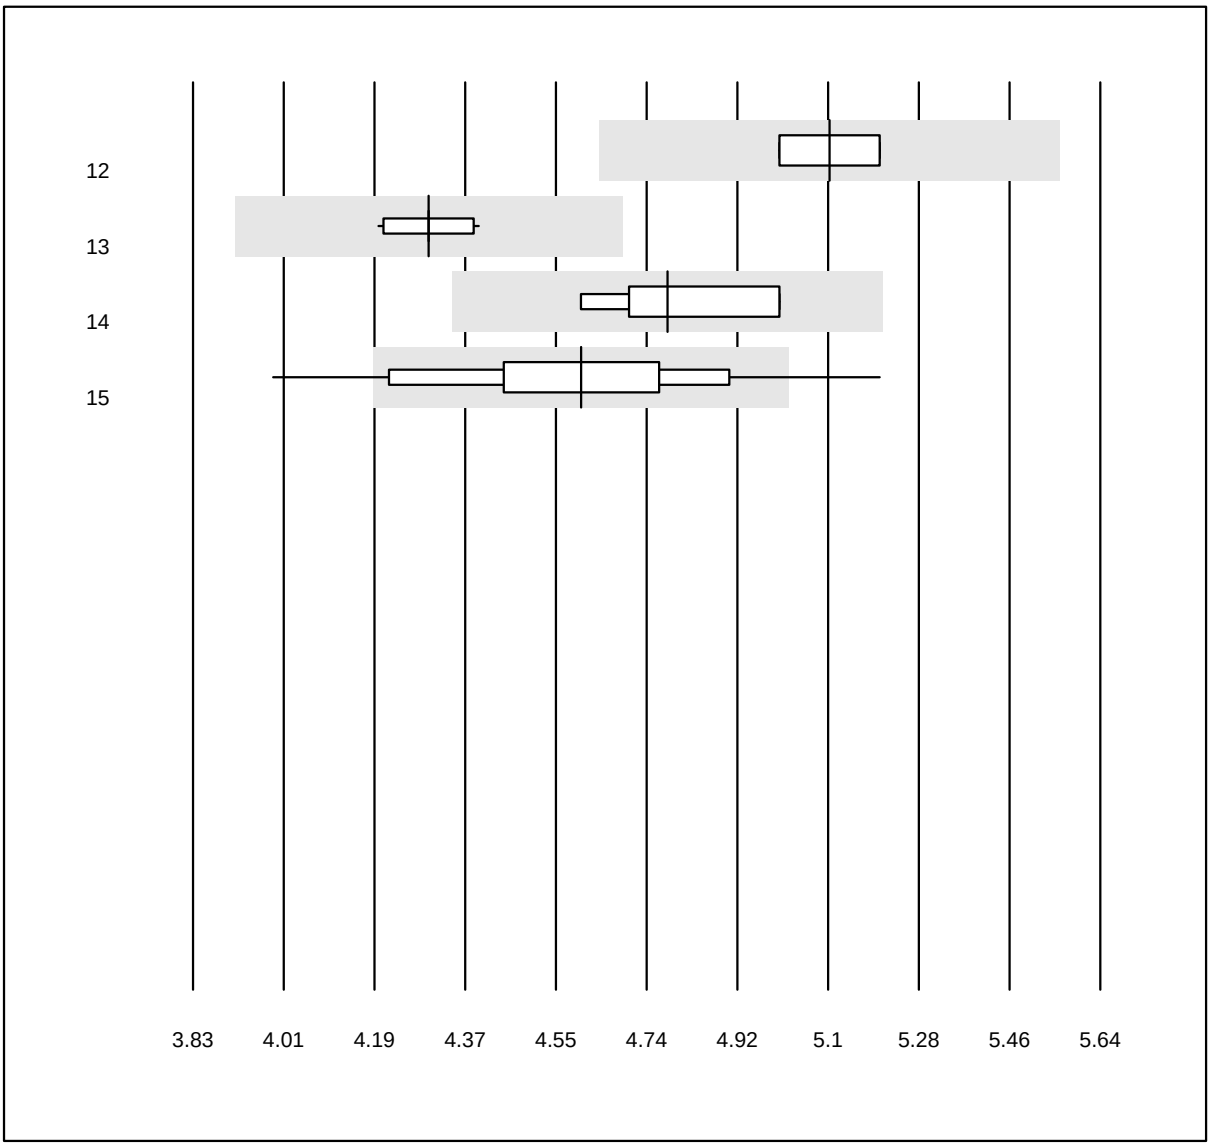


QUALAB Toleranz: 9% Glucose (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
12	Skyla	6	100.0	0.0	0.0	5.1	1.8	e
13	iStat Chem8	10	100.0	0.0	0.0	4.3	1.1	e
14	Vitros	7	100.0	0.0	0.0	4.8	3.0	e*
15	Cholestech LDX	198	83.8	10.1	6.1	4.6	5.3	e

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Glucose BGM 1

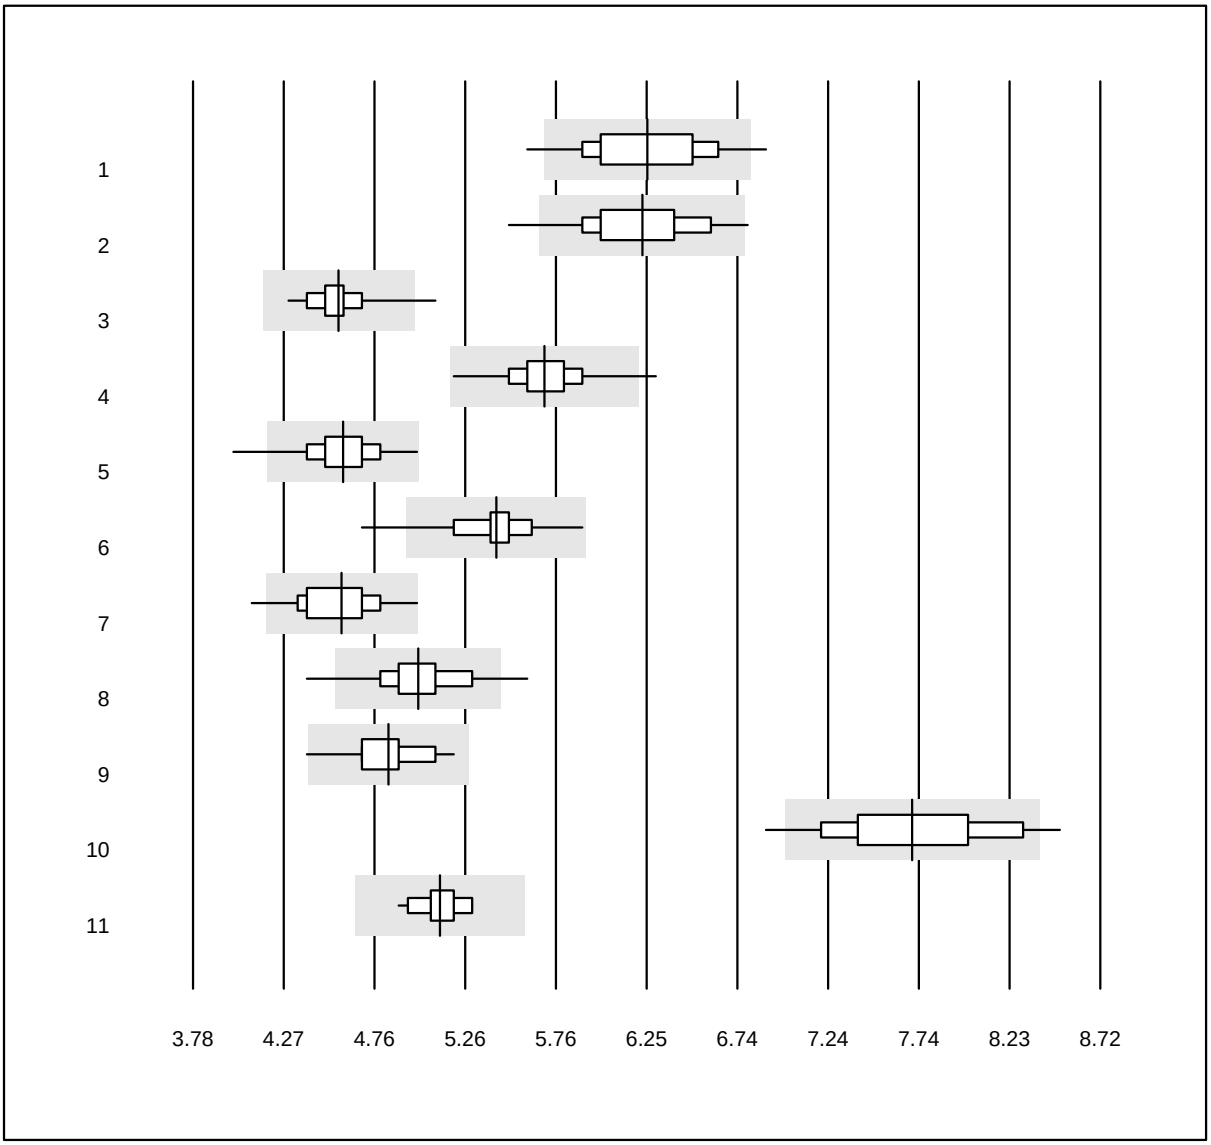


QUALAB Toleranz: 9%

Glucose BGM (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Hemocue 201RT P-equiv	141	94.3	1.4	4.3	6.3	4.5	e
2	Hemocue 201+ P-equiv	147	91.8	5.4	2.7	6.2	4.5	e
3	Cobas Pulse	350	98.0	2.0	0.0	4.6	2.8	e
4	Accu-Chek Inform 2	921	99.5	0.2	0.3	5.7	2.4	e
5	Accu-Check Guide	342	98.5	0.6	0.9	4.6	3.5	e
6	Accu-Chek Aviva	81	91.4	1.2	7.4	5.4	3.4	e
7	Accu-Chek Instant	136	96.3	2.2	1.5	4.6	4.1	e
8	Contour NEXT/XT	1526	97.6	1.3	1.1	5.0	3.9	e
9	Statstrip/Xpress	111	99.1	0.9	0.0	4.8	3.2	e
10	Healthpro	24	87.5	8.3	4.2	7.7	5.3	e
11	Alpha Check	14	100.0	0.0	0.0	5.1	2.2	e

8 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Glucose BGM 2

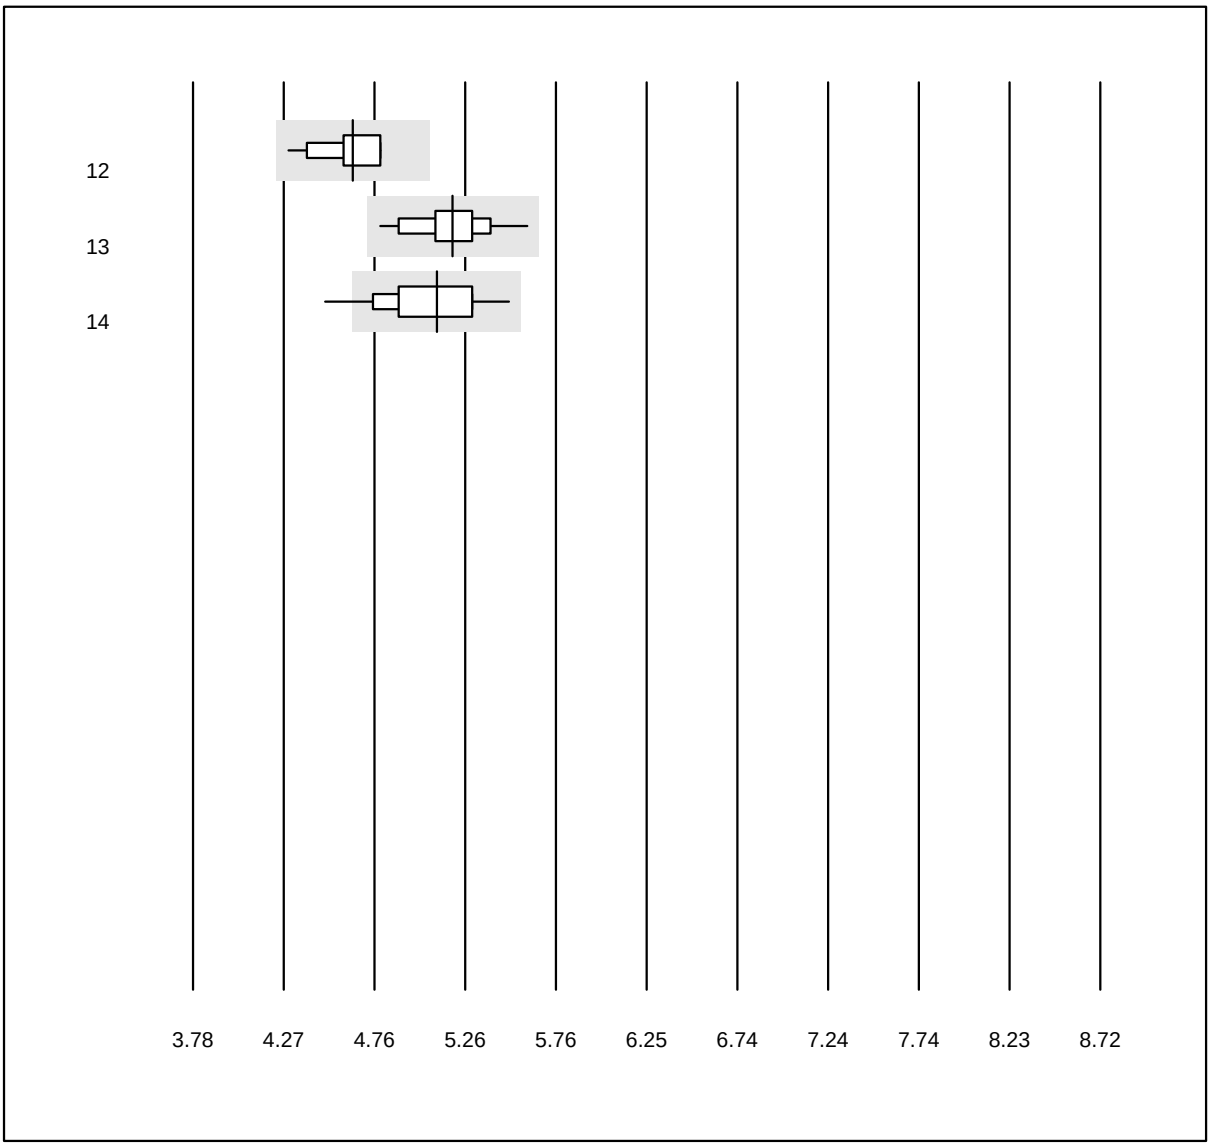


QUALAB Toleranz: 9% Glucose BGM (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
12	OneTouch Verio	31	100.0	0.0	0.0	4.7	3.2	e
13	Mylife UNIO	108	100.0	0.0	0.0	5.2	3.7	e
14	mylife Pura	35	94.3	5.7	0.0	5.1	4.4	e

8 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Acide urique 1

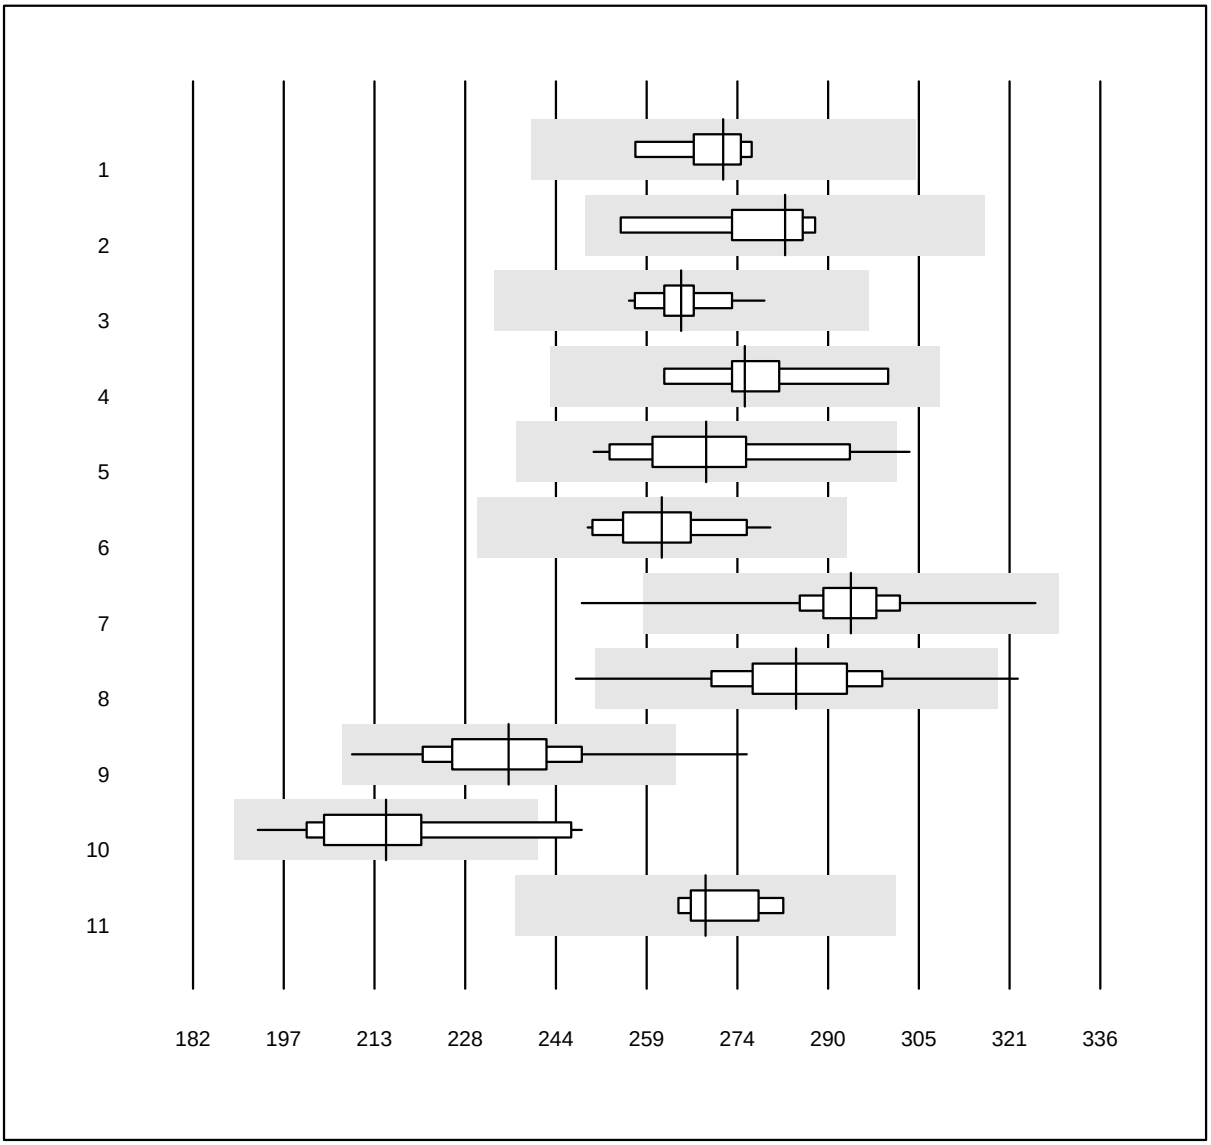


QUALAB Toleranz: 12%

Acide urique (µmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	8	100.0	0.0	0.0	272	2.3	e
2	Beckman	6	100.0	0.0	0.0	283	3.6	e*
3	Roche	44	100.0	0.0	0.0	265	2.0	e
4	Siemens	9	100.0	0.0	0.0	276	3.7	e
5	Autolyser	20	95.0	5.0	0.0	269	5.1	e
6	Selectra Pro	13	100.0	0.0	0.0	262	3.2	e
7	Fuji Dri-Chem	1080	99.2	0.3	0.6	294	2.6	e
8	Spotchem D-Concept	616	98.7	0.6	0.6	284	4.0	e
9	Spotchem SP-4430	88	90.9	3.4	5.7	236	5.3	e
10	Piccolo	32	75.0	12.5	12.5	215	7.1	e
11	Skyla	6	100.0	0.0	0.0	269	2.3	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Acide urique 2

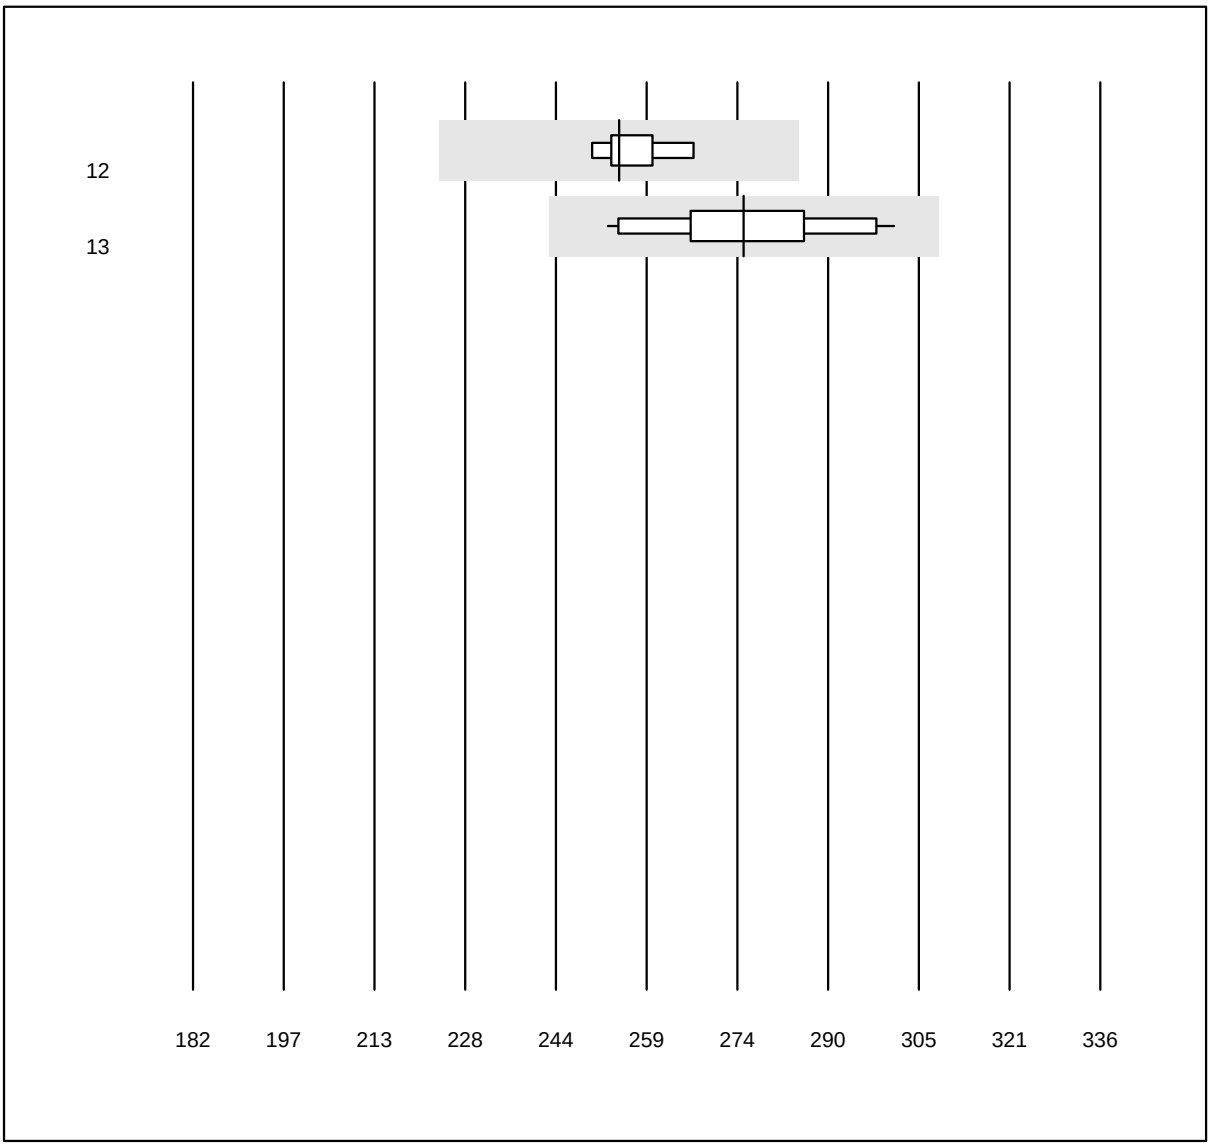


QUALAB Toleranz: 12%

Acide urique (µmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
12	Vitros	7	100.0	0.0	0.0	254	2.1	e
13	Seamaty	11	100.0	0.0	0.0	275	4.9	e*

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Urée 1

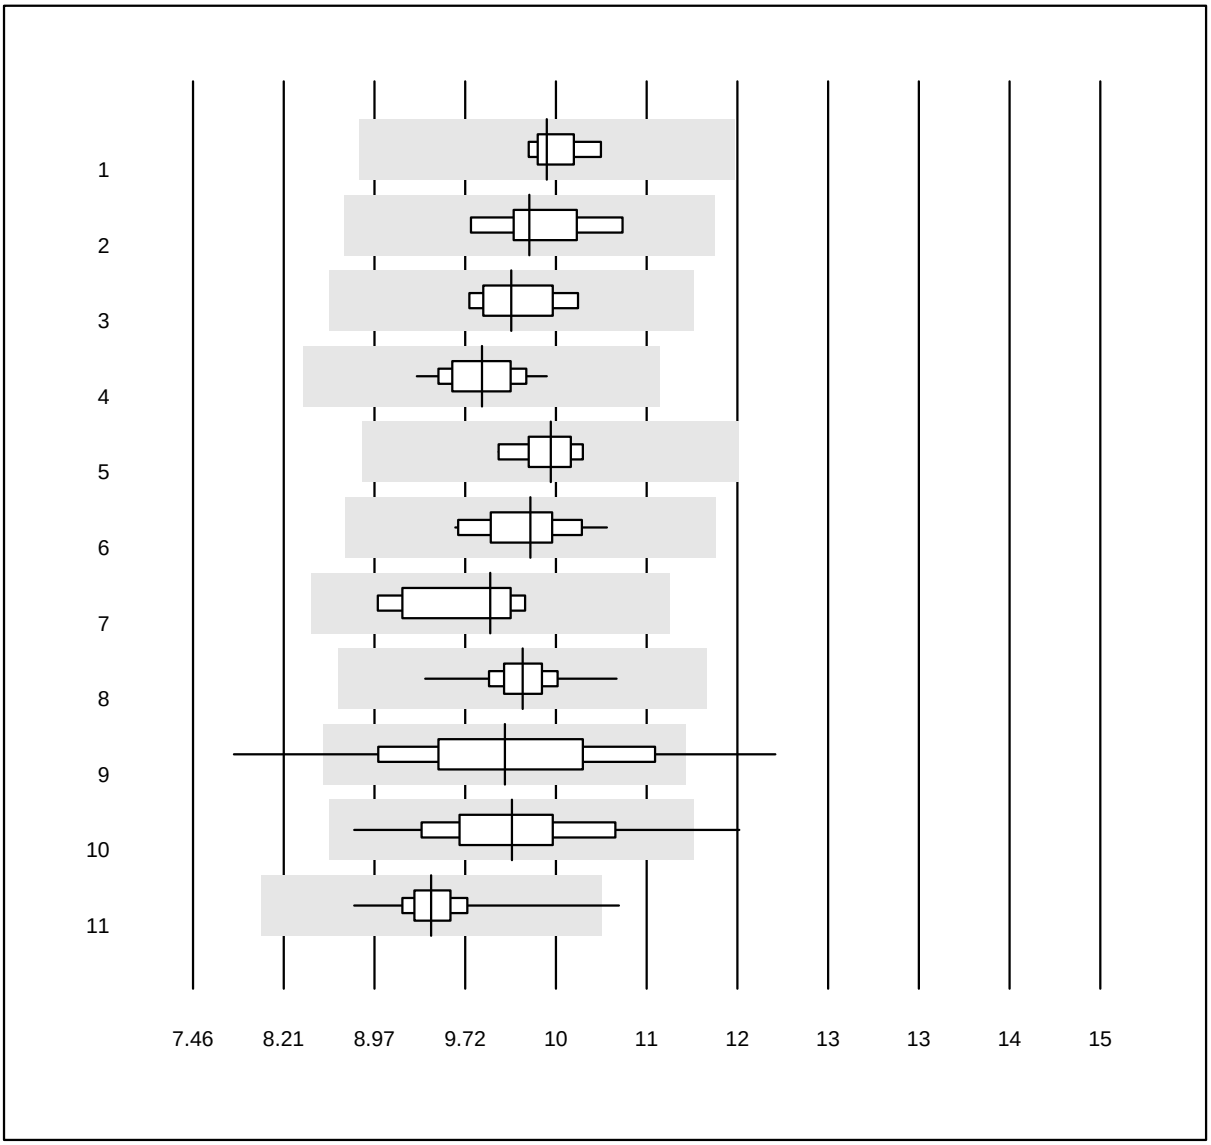


QUALAB Toleranz: 15%

Urée (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	EPOC	6	66.7	0.0	33.3	10.4	1.7	e
2	Abbott	8	100.0	0.0	0.0	10.3	3.6	e
3	Beckman	6	100.0	0.0	0.0	10.1	3.2	e
4	Roche	46	100.0	0.0	0.0	9.9	2.7	e
5	Siemens	9	100.0	0.0	0.0	10.4	2.2	e
6	Autolyser	18	94.4	0.0	5.6	10.3	3.4	e
7	Selectra Pro	8	87.5	0.0	12.5	9.9	4.8	e
8	Fuji Dri-Chem	635	99.7	0.0	0.3	10.2	2.3	e
9	Spotchem D-Concept	346	92.2	7.2	0.6	10.1	8.5	e
10	Spotchem SP-4430	42	97.6	2.4	0.0	10.1	6.2	e
11	Piccolo	66	97.0	1.5	1.5	9.4	3.4	e

Urée 2

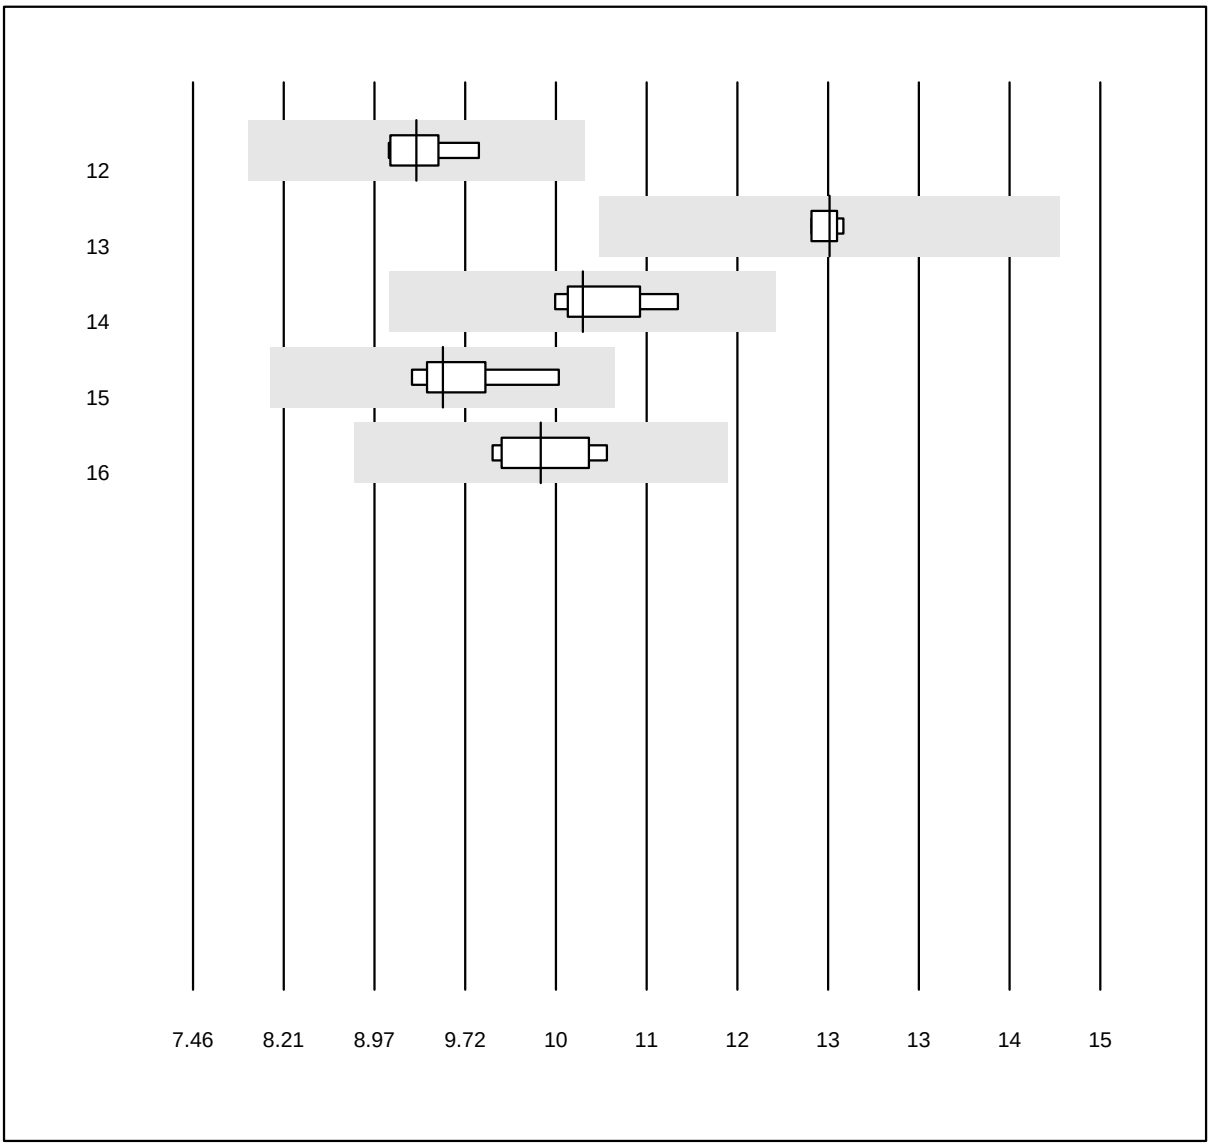


QUALAB Toleranz: 15%

Urée (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
12	Vitros	7	100.0	0.0	0.0	9.3	2.6	e
13	iStat Chem8	6	100.0	0.0	0.0	12.8	0.9	e
14	Skyla	6	100.0	0.0	0.0	10.7	3.2	e
15	Seamaty	9	100.0	0.0	0.0	9.5	3.9	e
16	Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	10.3	3.7	e*

Potassium 1

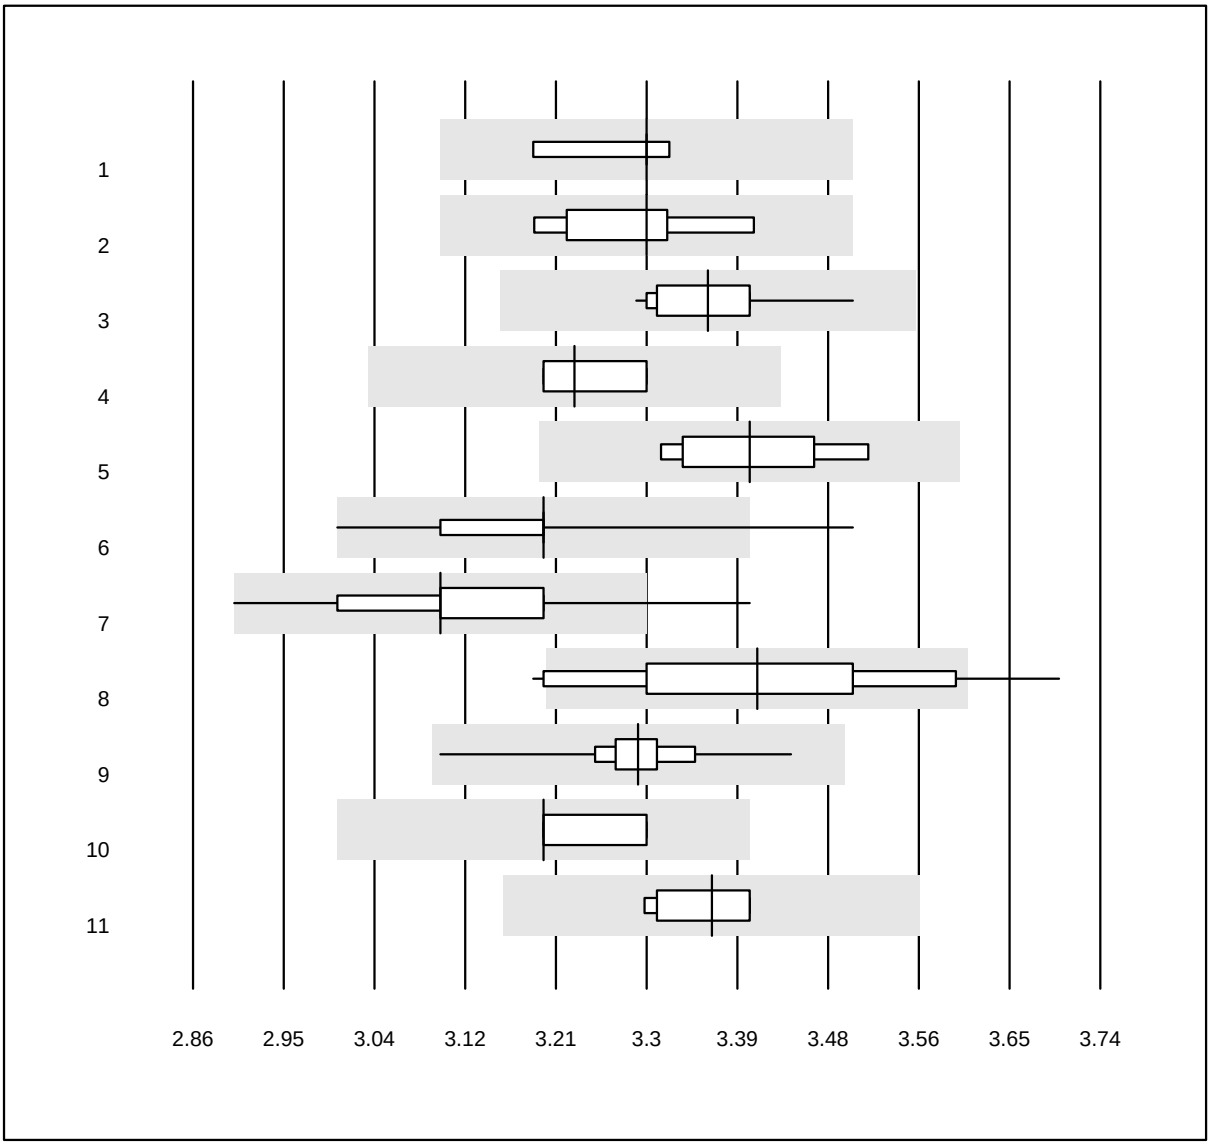


QUALAB Toleranz: 6%

Potassium (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	8	100.0	0.0	0.0	3.30	1.1	e
2	Beckman	6	100.0	0.0	0.0	3.30	1.9	e*
3	Roche	47	100.0	0.0	0.0	3.36	1.4	e
4	Siemens	8	100.0	0.0	0.0	3.23	1.5	e
5	Autolyser	6	100.0	0.0	0.0	3.40	2.0	e*
6	Fuji Dri-Chem	1127	97.5	1.8	0.7	3.20	1.5	e
7	Spotchem D-Concept	507	92.1	3.2	4.7	3.10	2.5	e
8	Piccolo	38	55.3	13.2	31.6	3.41	4.3	e
9	Exias	114	98.2	0.0	1.8	3.29	1.2	e
10	iStat Chem8	11	100.0	0.0	0.0	3.20	1.4	e
11	Vitros	7	100.0	0.0	0.0	3.36	1.3	e

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Potassium 2

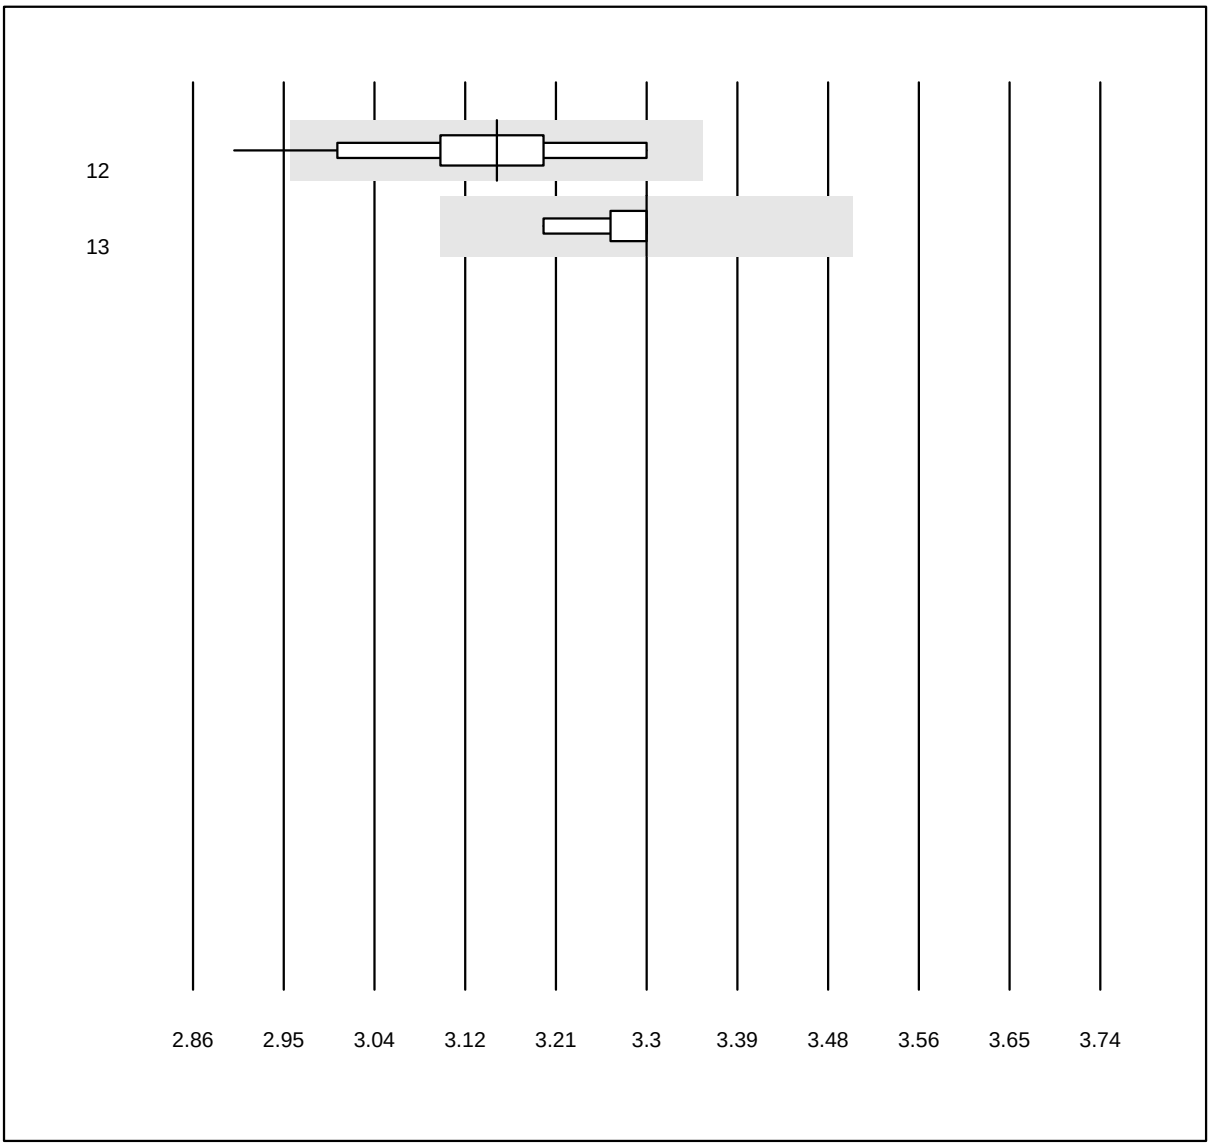


QUALAB Toleranz: 6%
(< 3.3: +/- 0.2 mmol/l)

Potassium (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
12	Spotchem EL-SE 1520	61	95.1	1.6	3.3	3.15	2.9	e
13	i-Smart 30 PRO	17	100.0	0.0	0.0	3.30	1.2	e

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Créatine-kinase 1

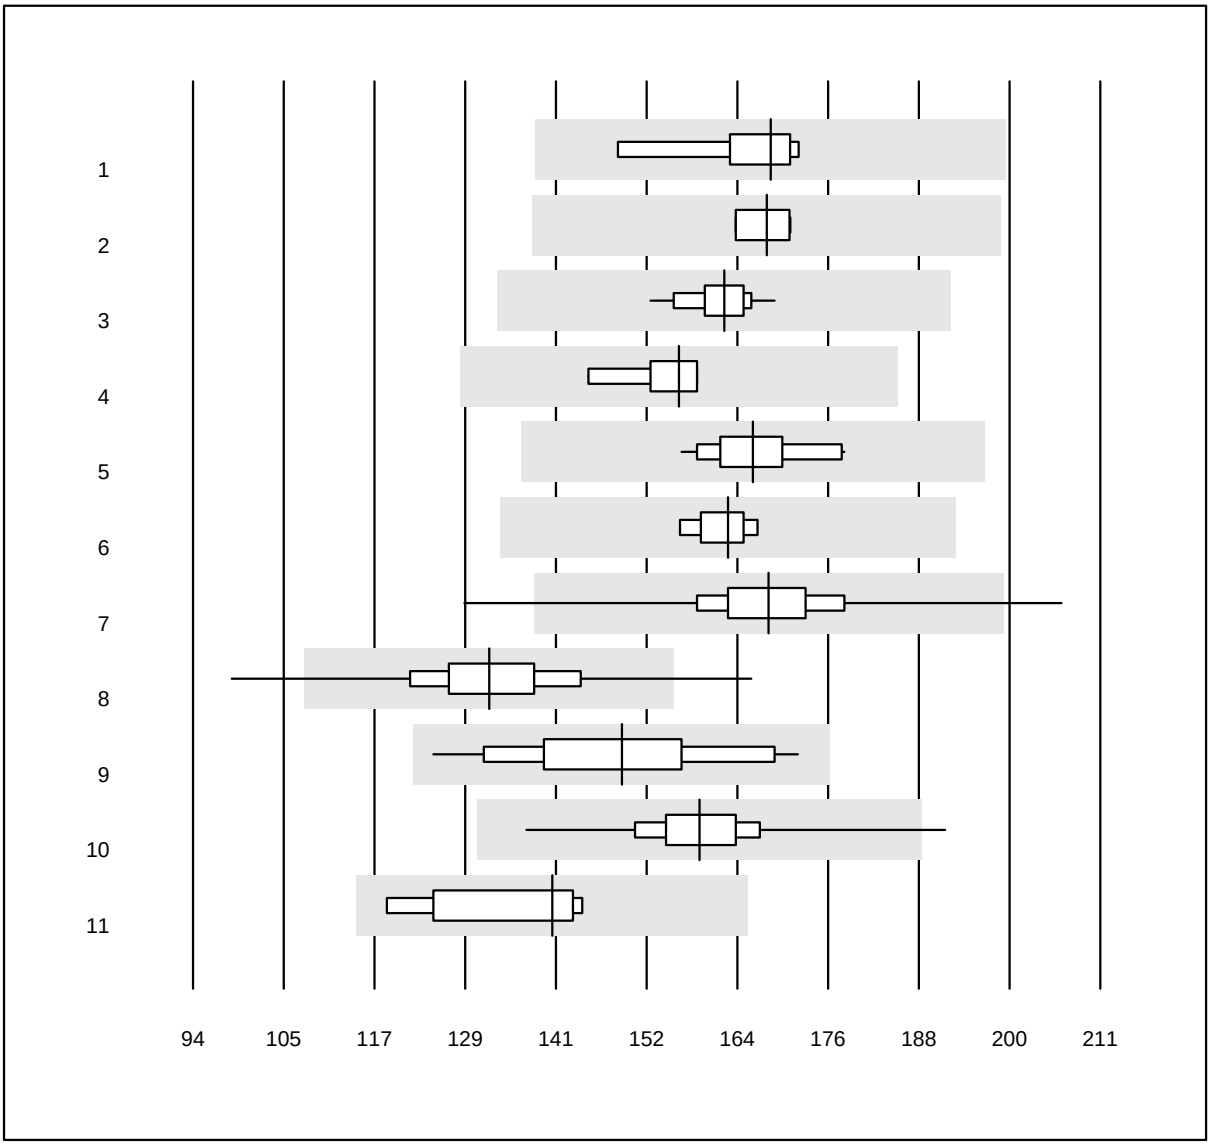


QUALAB Toleranz: 18%

Créatine-kinase (U/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	8	100.0	0.0	0.0	169	4.4	e
2	Beckman	6	100.0	0.0	0.0	168	1.9	e
3	Roche	44	100.0	0.0	0.0	163	2.3	e
4	Siemens	9	100.0	0.0	0.0	157	3.0	e
5	Autolyser	19	100.0	0.0	0.0	166	3.4	e
6	Selectra Pro	5	100.0	0.0	0.0	163	1.9	e
7	Fuji Dri-Chem	682	98.5	0.7	0.7	168	5.1	e
8	Spotchem D-Concept	323	98.8	1.2	0.0	132	6.7	e
9	Spotchem SP-4430	35	97.1	0.0	2.9	149	8.5	e
10	Piccolo	23	91.3	4.3	4.3	159	6.0	e
11	Vitros	7	100.0	0.0	0.0	140	7.1	e*

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Créatine-kinase 2

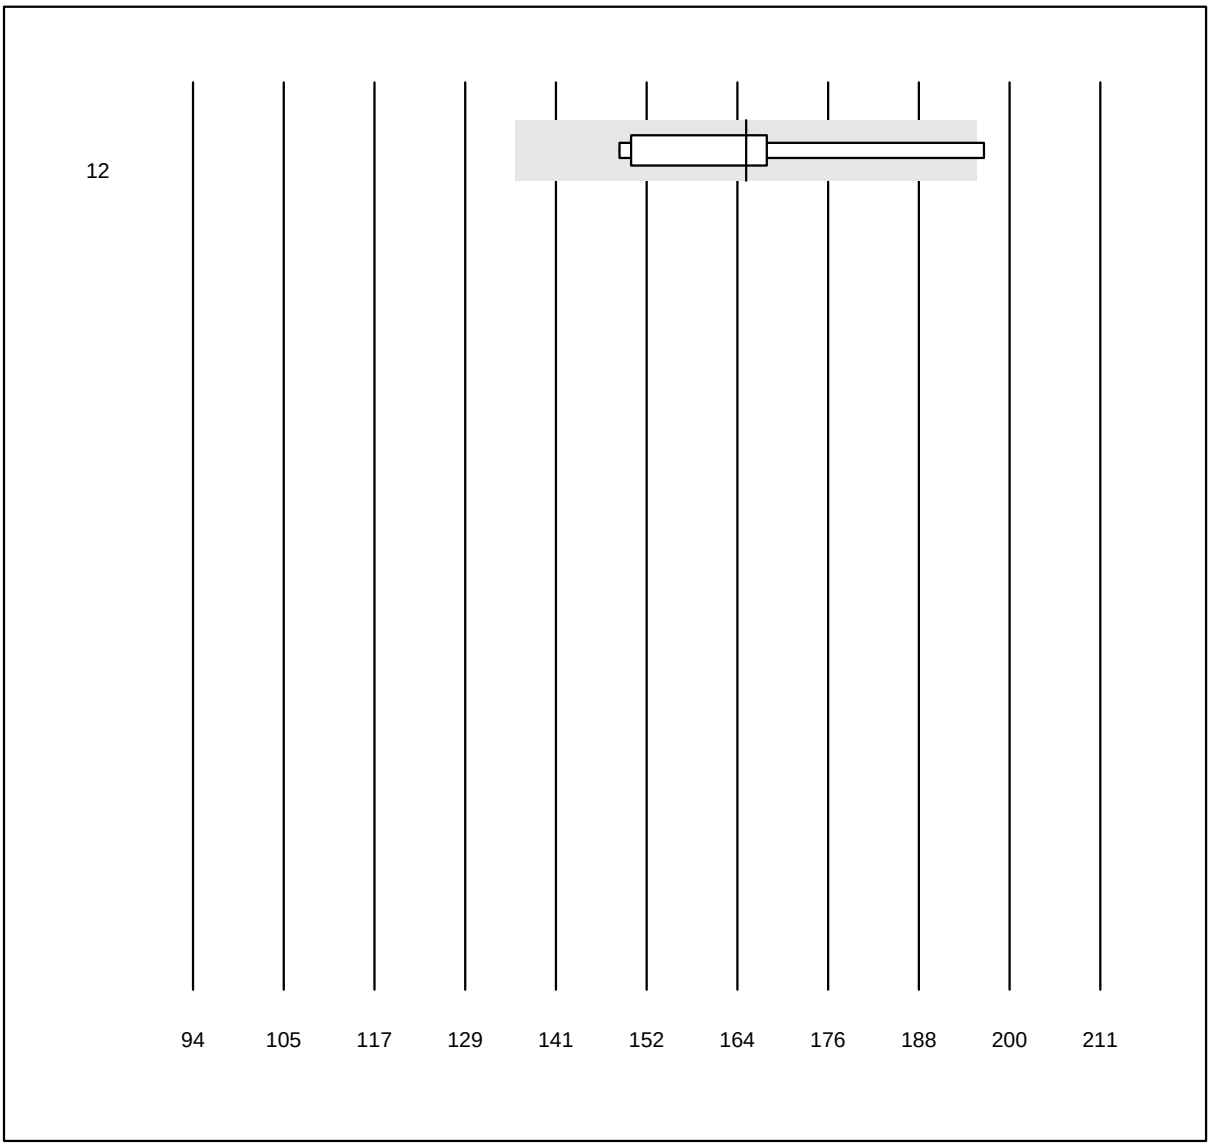


QUALAB Toleranz: 18%

Créatine-kinase (U/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
12	Seamaty	9	88.9	11.1	0.0	165	8.8	e*

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Créatinine 1

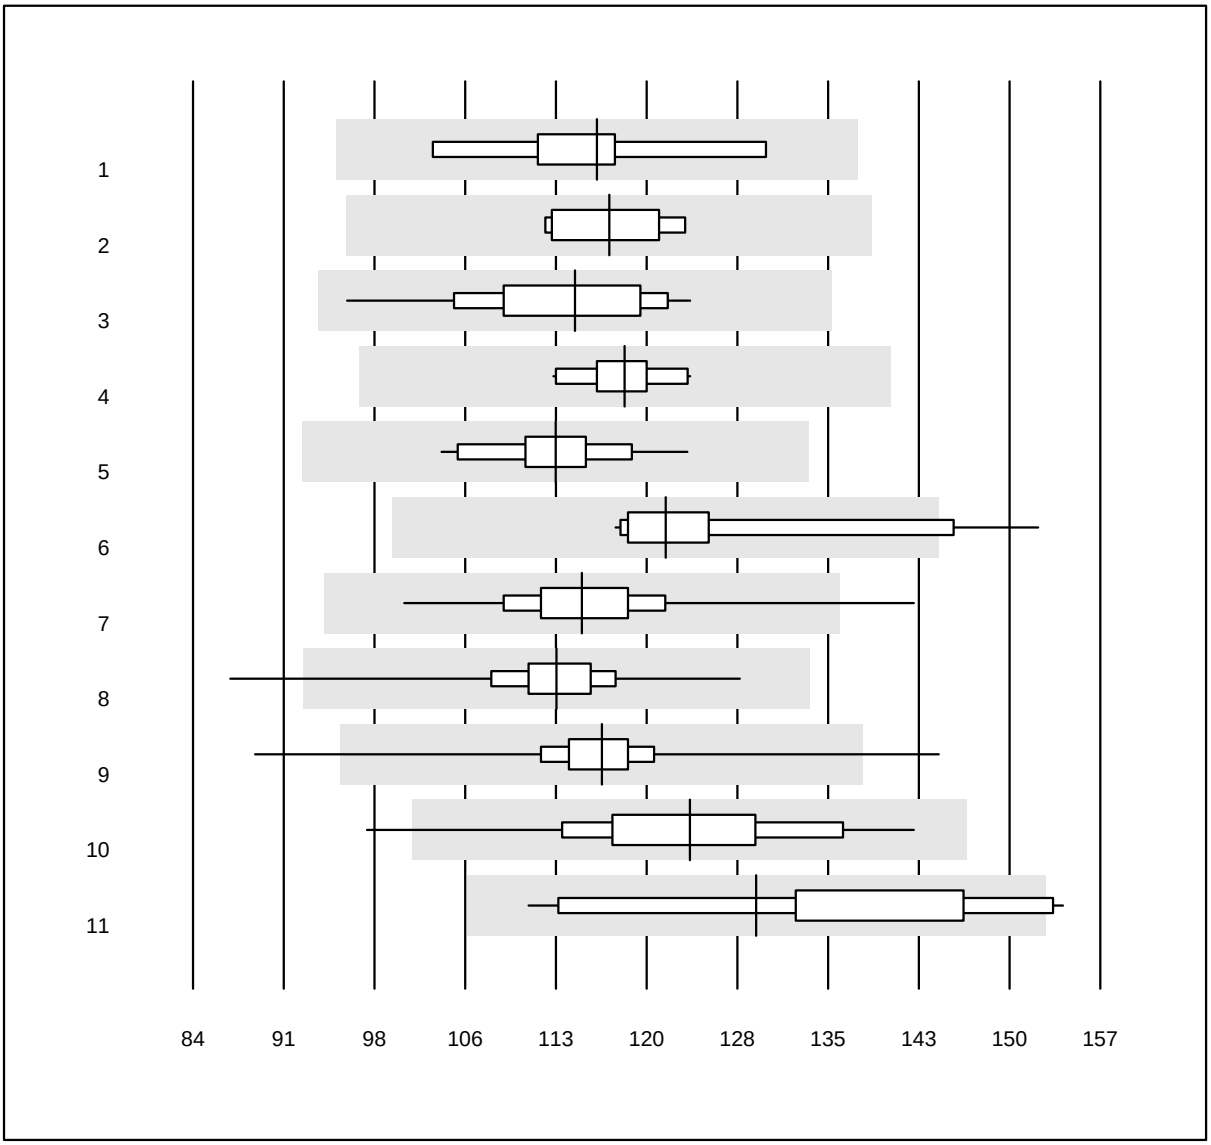


QUALAB Toleranz: 18%

Créatinine (µmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	8	100.0	0.0	0.0	117	6.1	e
2	Beckman	6	100.0	0.0	0.0	118	3.8	e
3	Roche	47	100.0	0.0	0.0	115	5.8	e
4	Siemens	10	100.0	0.0	0.0	119	2.8	e
5	Autolyser	23	95.7	0.0	4.3	113	4.2	e
6	Selectra Pro	14	85.7	7.1	7.1	122	7.5	e
7	Fuji Dri-Chem	1196	99.1	0.4	0.5	115	4.7	e
8	Spotchem D-Concept	670	99.0	0.1	0.9	113	3.7	e
9	Spotchem SP-4430	128	98.4	1.6	0.0	117	4.2	e
10	Piccolo	68	94.1	2.9	2.9	124	7.5	e
11	EPOC	21	71.4	9.5	19.0	129	8.6	e

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Créatinine 2

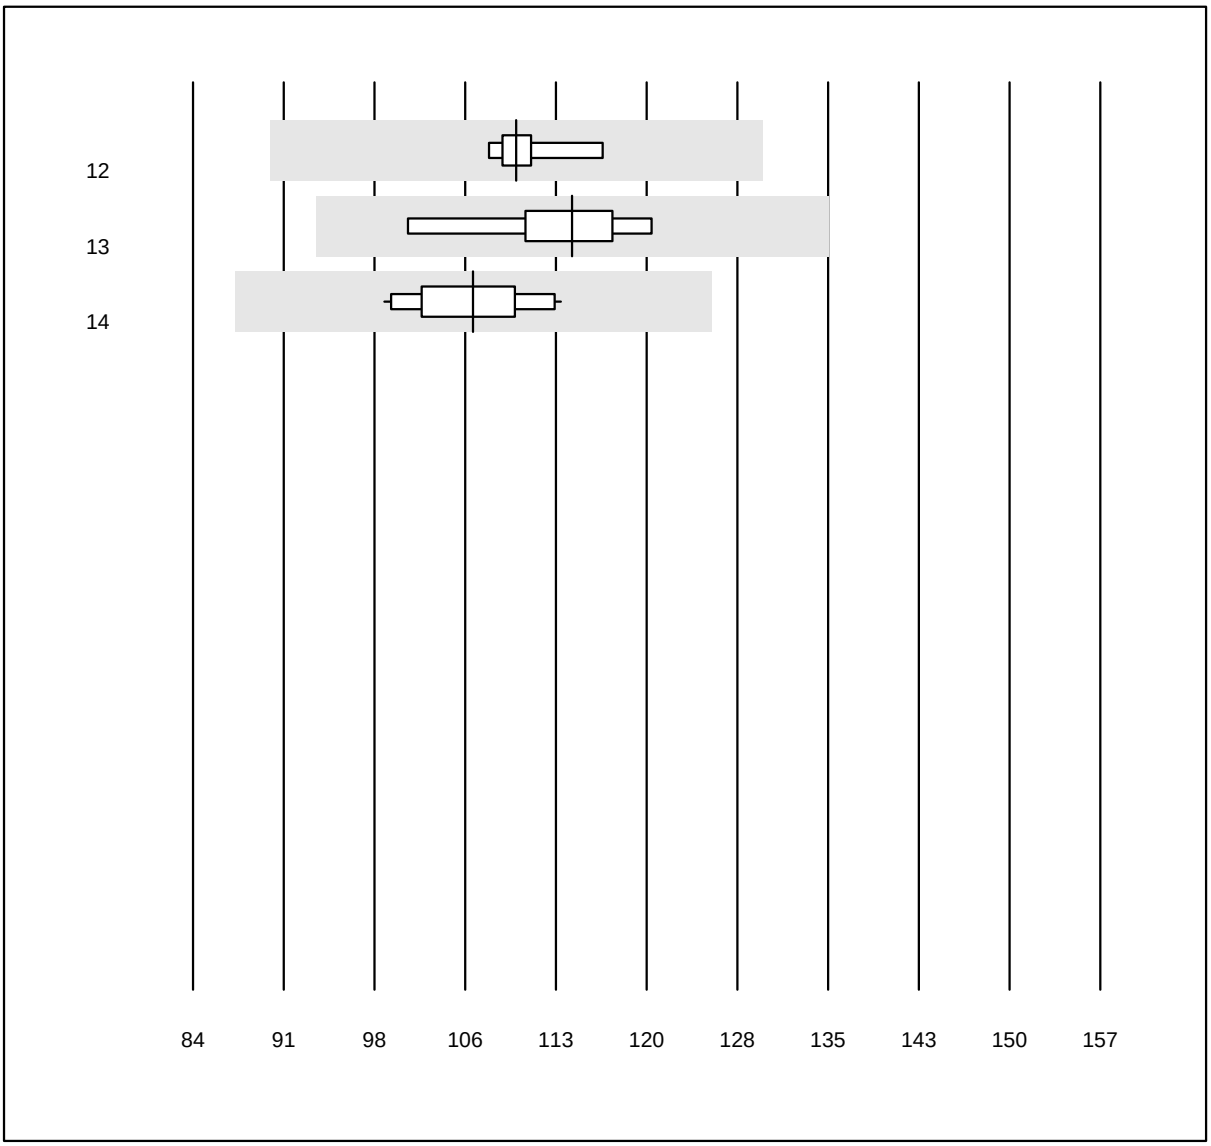


QUALAB Toleranz: 18%

Créatinine (µmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
12	Vitros	7	100.0	0.0	0.0	110	2.3	e
13	Skyla	6	100.0	0.0	0.0	115	4.8	e
14	Seamaty	11	100.0	0.0	0.0	107	4.2	e

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Créatinine E

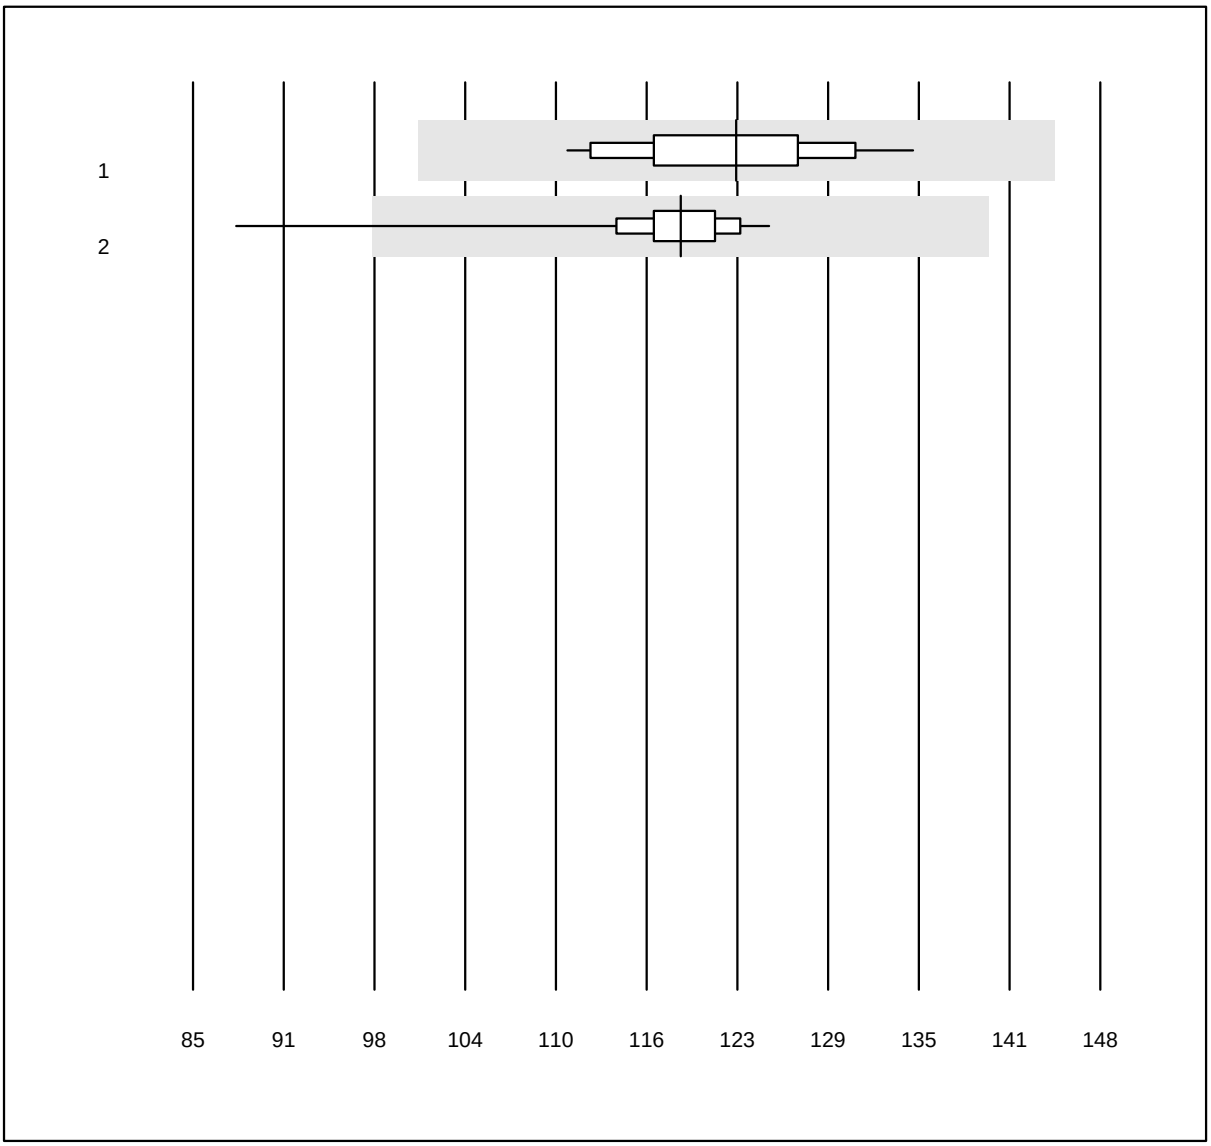


QUALAB Toleranz: 18%

Créatinine E (µmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	ABL700/800	18	94.4	0.0	5.6	123	5.3	e
2	iStat Chem8	47	95.7	2.1	2.1	119	4.6	e

Laktat

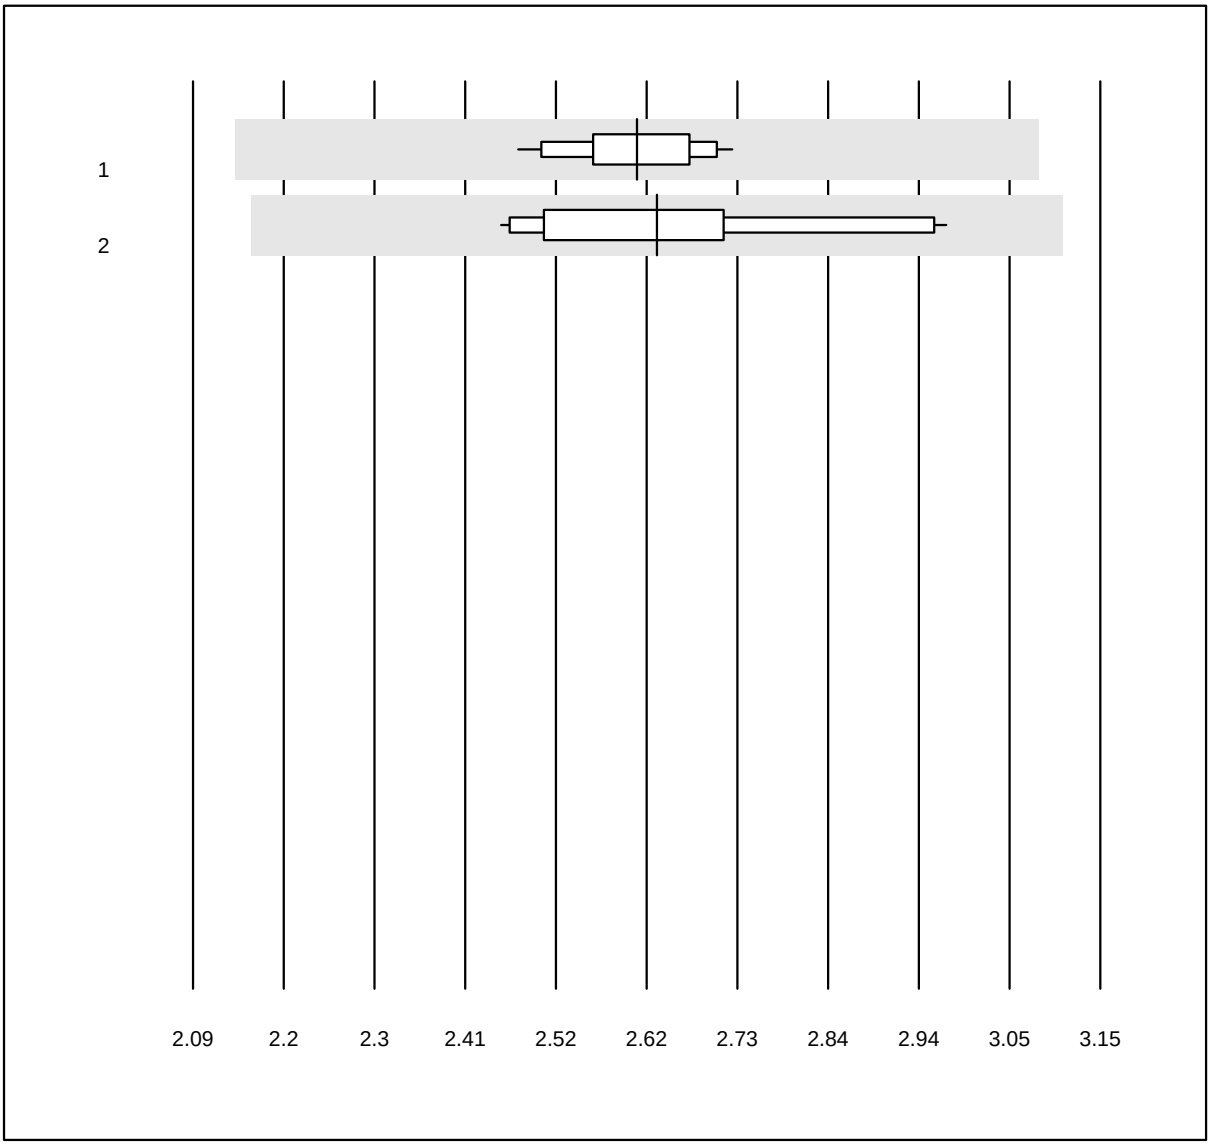


QUALAB Toleranz: 18%

Laktat (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	18	100.0	0.0	0.0	2.61	2.8	e
2	Autres méthodes	11	100.0	0.0	0.0	2.63	6.2	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

LDH

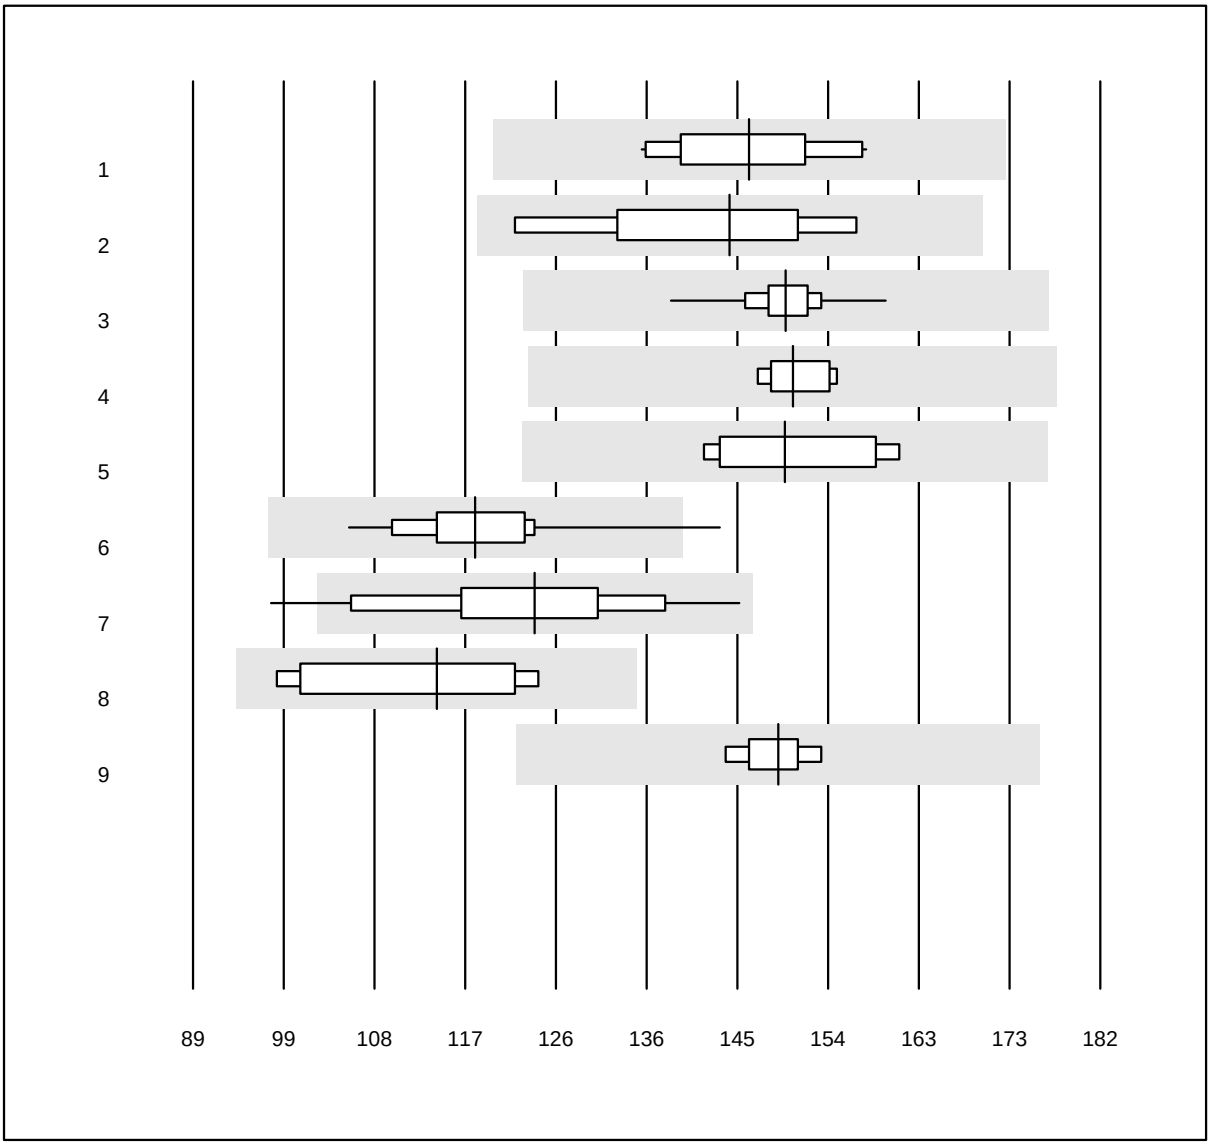


QUALAB Toleranz: 18%

LDH (U/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	10	100.0	0.0	0.0	146	5.1	e
2	Beckman	4	100.0	0.0	0.0	144	7.0	e*
3	Roche	45	100.0	0.0	0.0	150	2.4	e
4	Siemens	8	100.0	0.0	0.0	151	2.0	e
5	Autolyser	7	100.0	0.0	0.0	150	5.1	e
6	Fuji Dri-Chem	87	93.1	2.3	4.6	118	5.6	e
7	Spotchem D-Concept	25	92.0	8.0	0.0	124	9.3	e
8	Spotchem SP-4430	8	87.5	0.0	12.5	114	9.4	e*
9	Vitros	7	100.0	0.0	0.0	149	2.1	e

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Cholésterol LDL

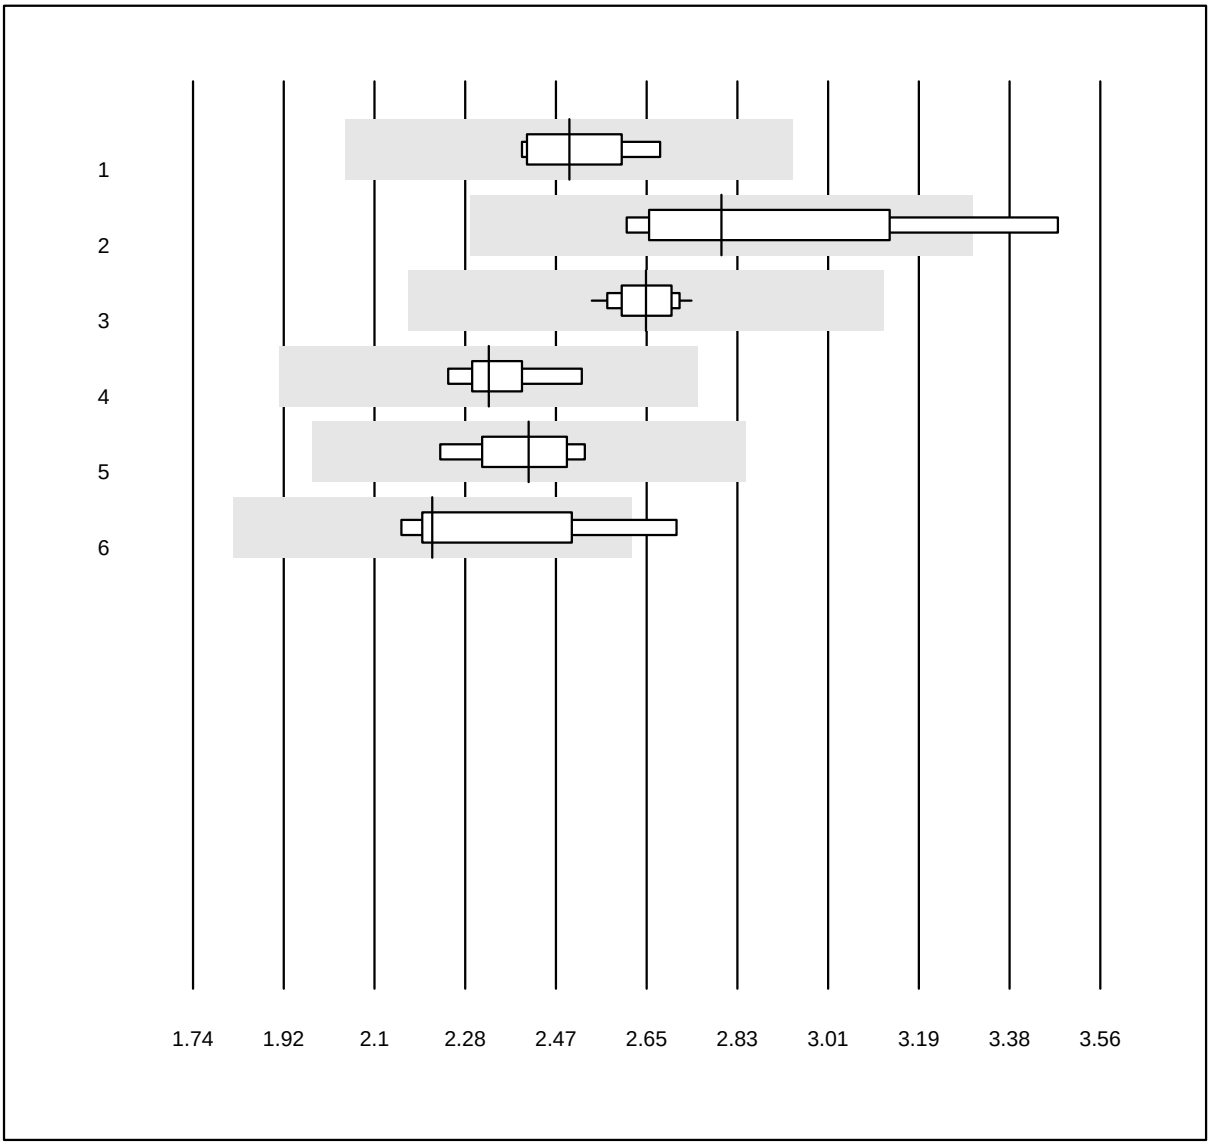


QUALAB Toleranz: 18%

Cholésterol LDL (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	8	100.0	0.0	0.0	2.5	4.0	e
2	Beckman	4	100.0	0.0	0.0	2.8	9.7	a*
3	Roche	26	100.0	0.0	0.0	2.6	2.2	e
4	Siemens	7	100.0	0.0	0.0	2.3	3.6	e
5	Autolyser	7	100.0	0.0	0.0	2.4	3.9	e
6	Selectra	6	83.3	16.7	0.0	2.2	8.2	e*

Lithium

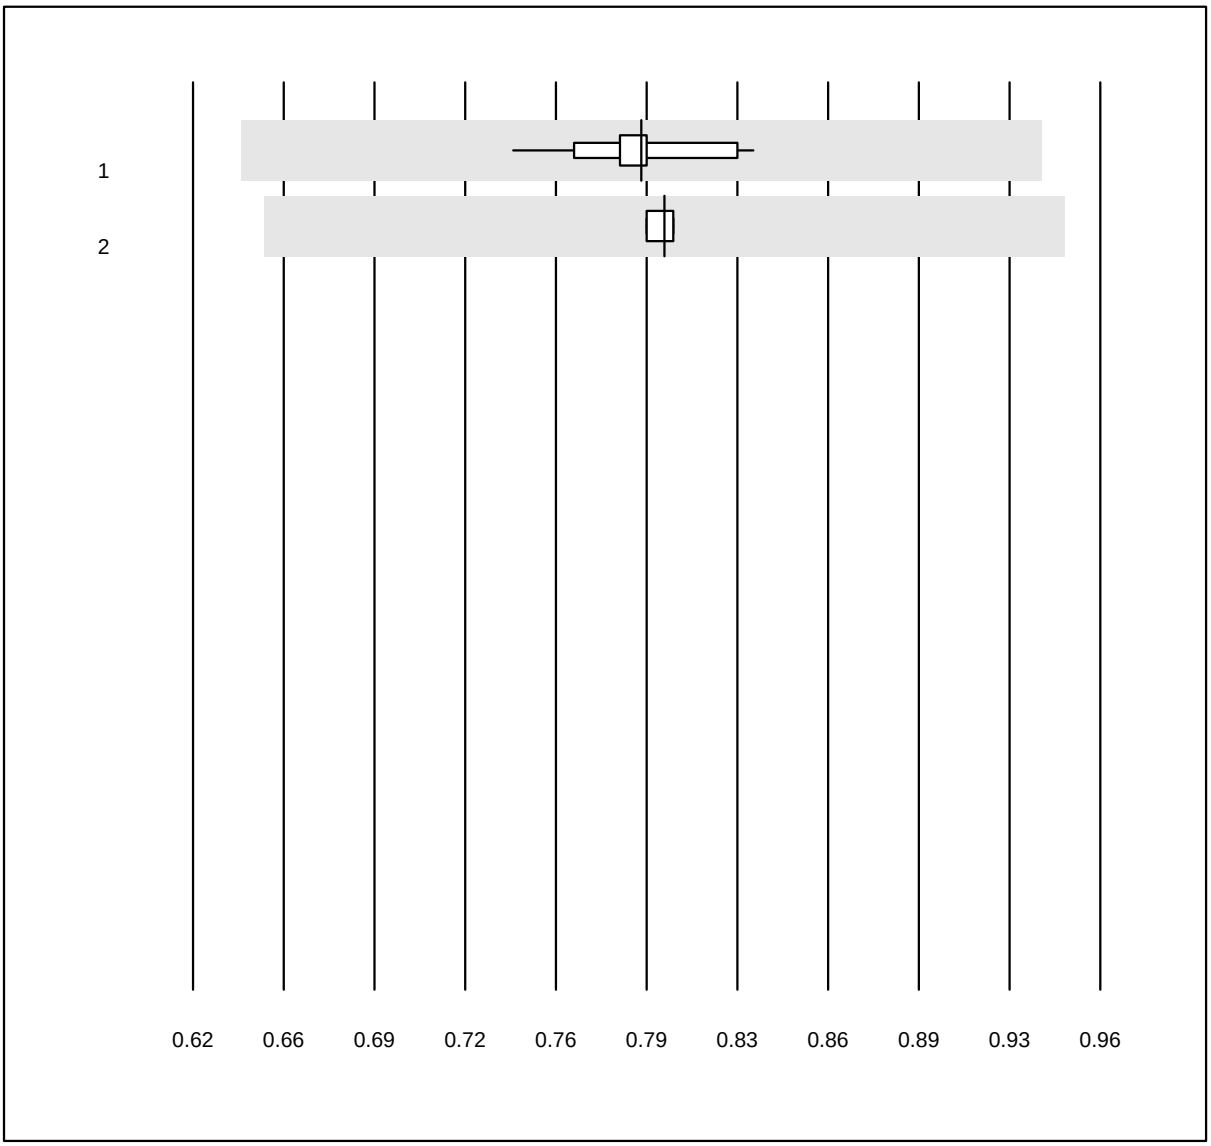


QUALAB Toleranz: 15%
(< 1.0: +/- 0.15 mmol/l)

Lithium (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	15	100.0	0.0	0.0	0.79	2.5	e
2	Autres méthodes	5	100.0	0.0	0.0	0.80	0.7	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Magnésium

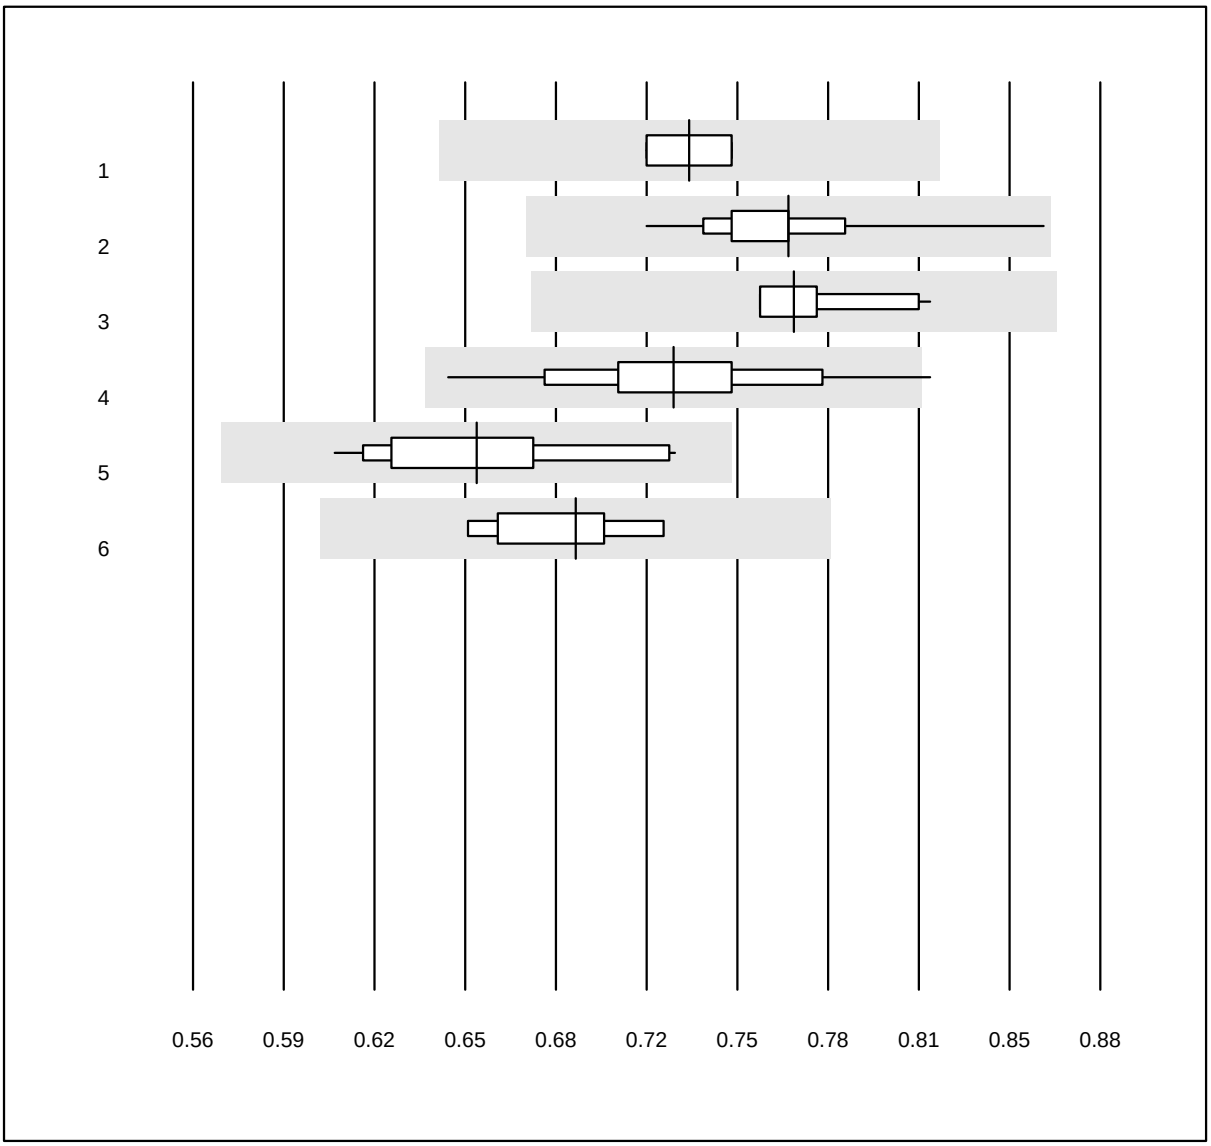


QUALAB Toleranz: 12%

Magnésium (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	8	100.0	0.0	0.0	0.73	1.9	e
2	Roche	40	100.0	0.0	0.0	0.77	3.0	a
3	Siemens	10	100.0	0.0	0.0	0.77	2.3	e
4	Fuji Dri-Chem	44	93.2	4.5	2.3	0.73	4.8	e
5	Spotchem D-Concept	22	95.5	0.0	4.5	0.66	5.6	e
6	Vitros	6	100.0	0.0	0.0	0.69	3.2	e

6 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Sodium 1

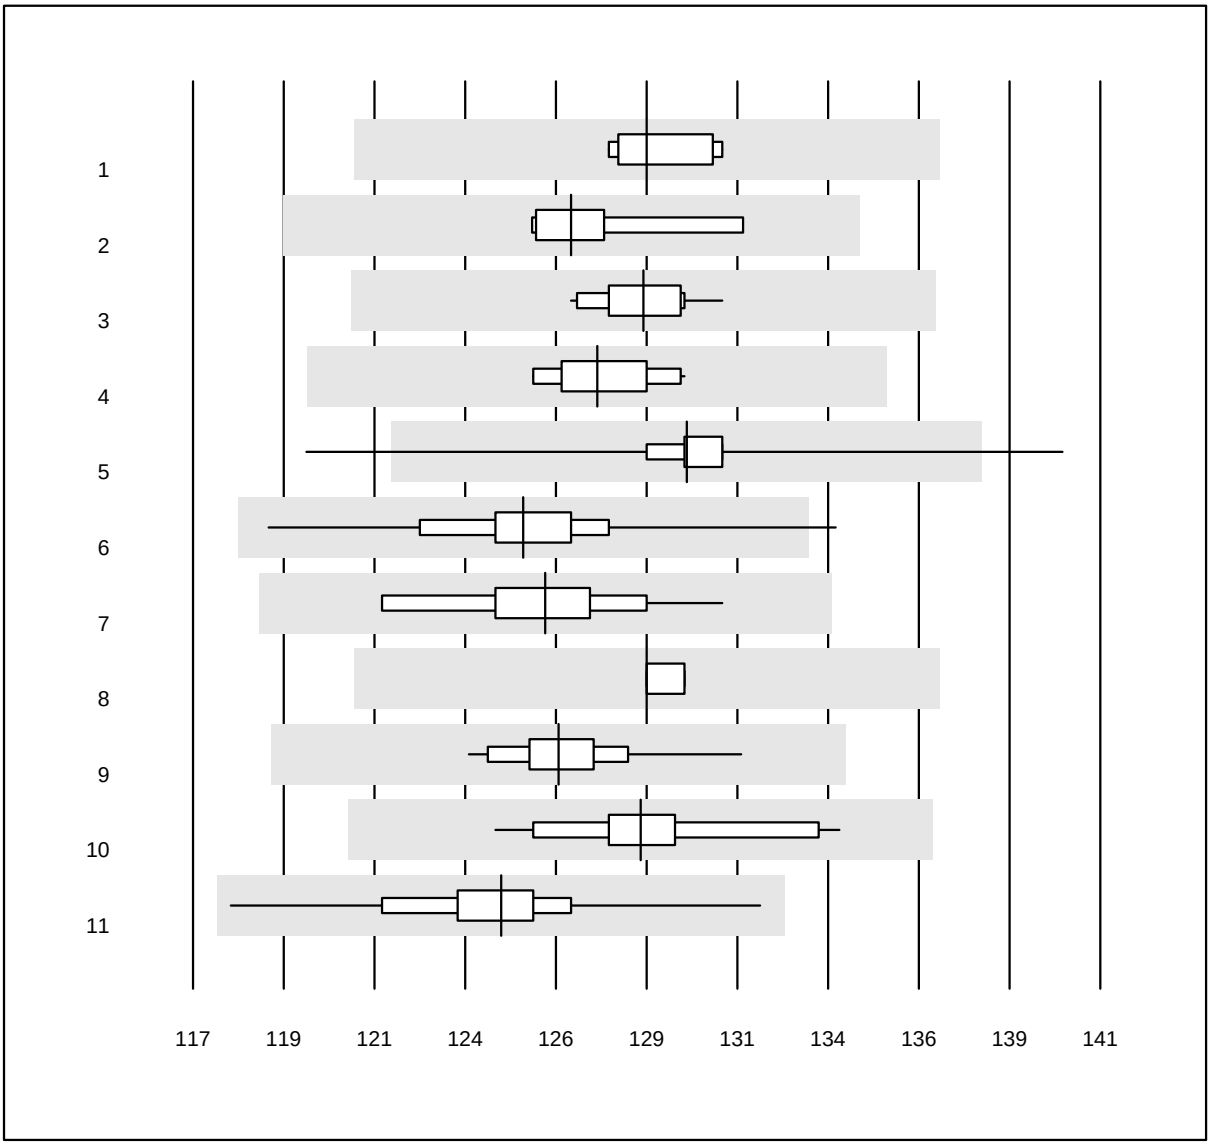


QUALAB Toleranz: 6%

Sodium (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	8	100.0	0.0	0.0	129	0.9	e
2	Beckman	6	100.0	0.0	0.0	127	1.3	e
3	Roche	47	100.0	0.0	0.0	129	0.8	e
4	Siemens	10	100.0	0.0	0.0	128	1.0	e
5	Fuji Dri-Chem	1055	99.0	0.4	0.7	130	1.1	e
6	Spotchem D-Concept	447	99.3	0.2	0.4	126	1.5	e
7	Piccolo	37	100.0	0.0	0.0	126	1.8	e
8	iStat Chem8	10	100.0	0.0	0.0	129	0.4	e
9	Exias	110	98.2	0.0	1.8	127	1.2	e
10	i-Smart 30 PRO	14	100.0	0.0	0.0	129	1.9	e
11	Spotchem EL-SE 1520	49	95.9	0.0	4.1	125	1.9	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Sodium 2

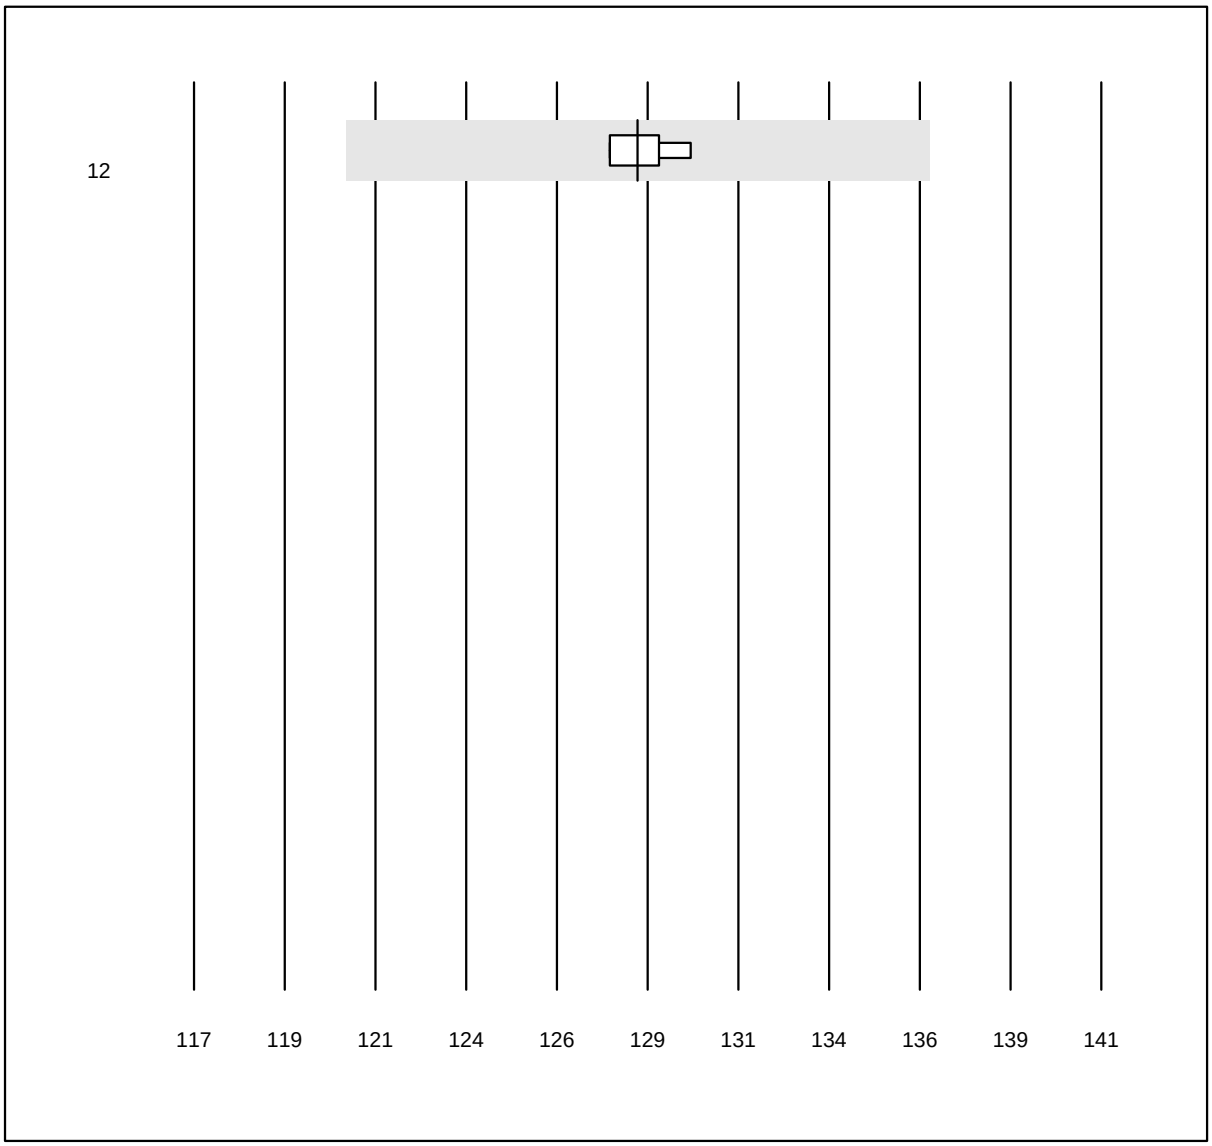


QUALAB Toleranz: 6%

Sodium (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
12	Vitros	7	100.0	0.0	0.0	129	0.6	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Amylase pancréatique

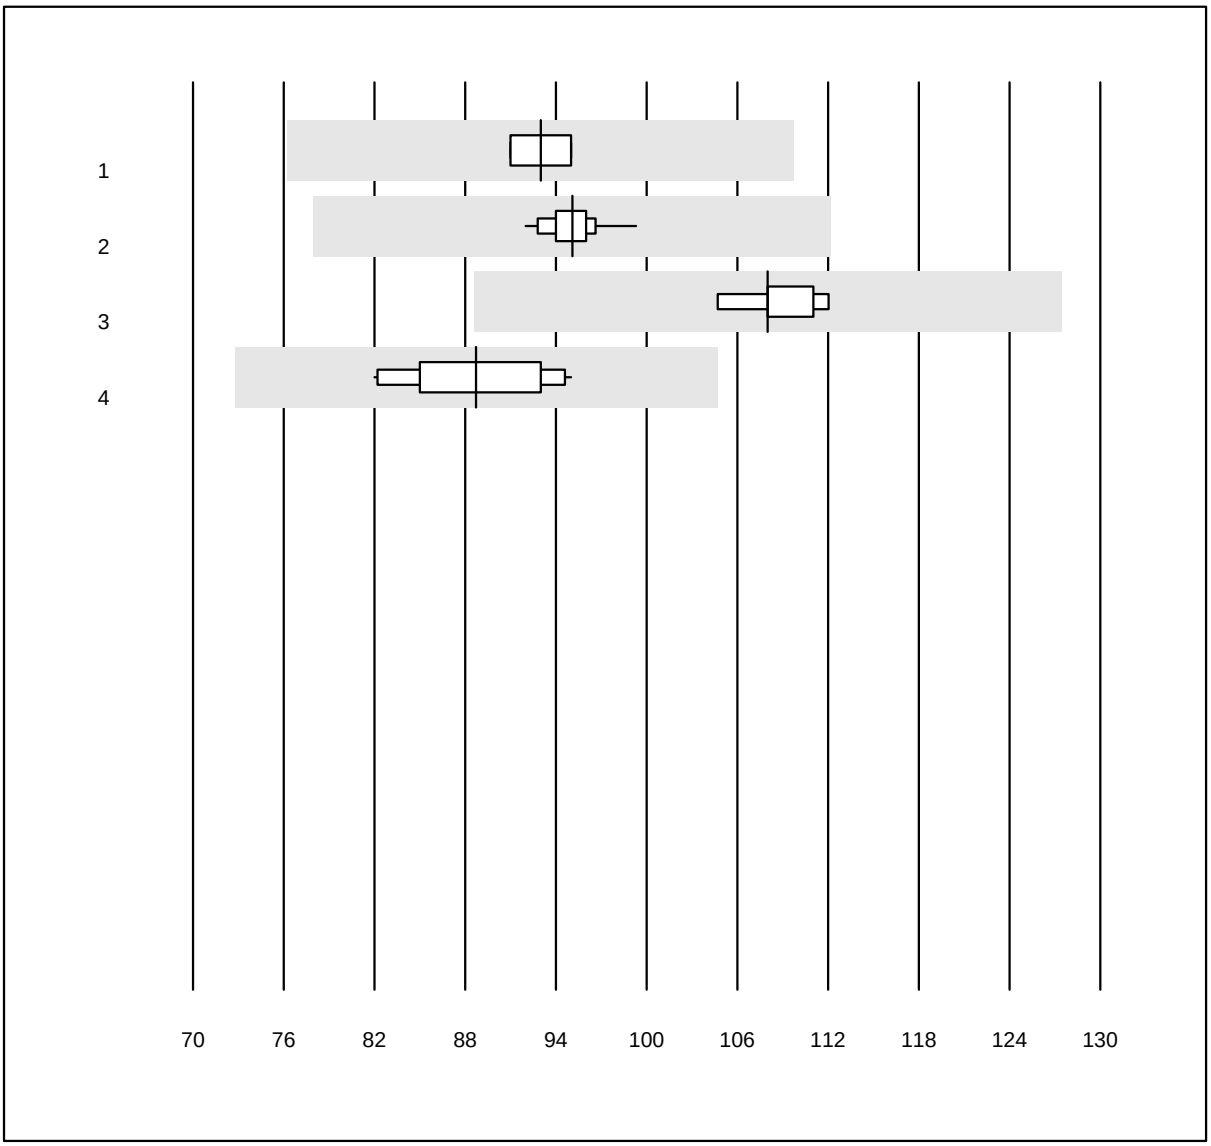


QUALAB Toleranz: 18%

Amylase pancréatique (U/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	6	100.0	0.0	0.0	93	2.0	e
2	Roche	27	100.0	0.0	0.0	95	1.6	e
3	Siemens	8	100.0	0.0	0.0	108	2.1	e
4	Autolyser	11	100.0	0.0	0.0	89	4.9	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Phosphates

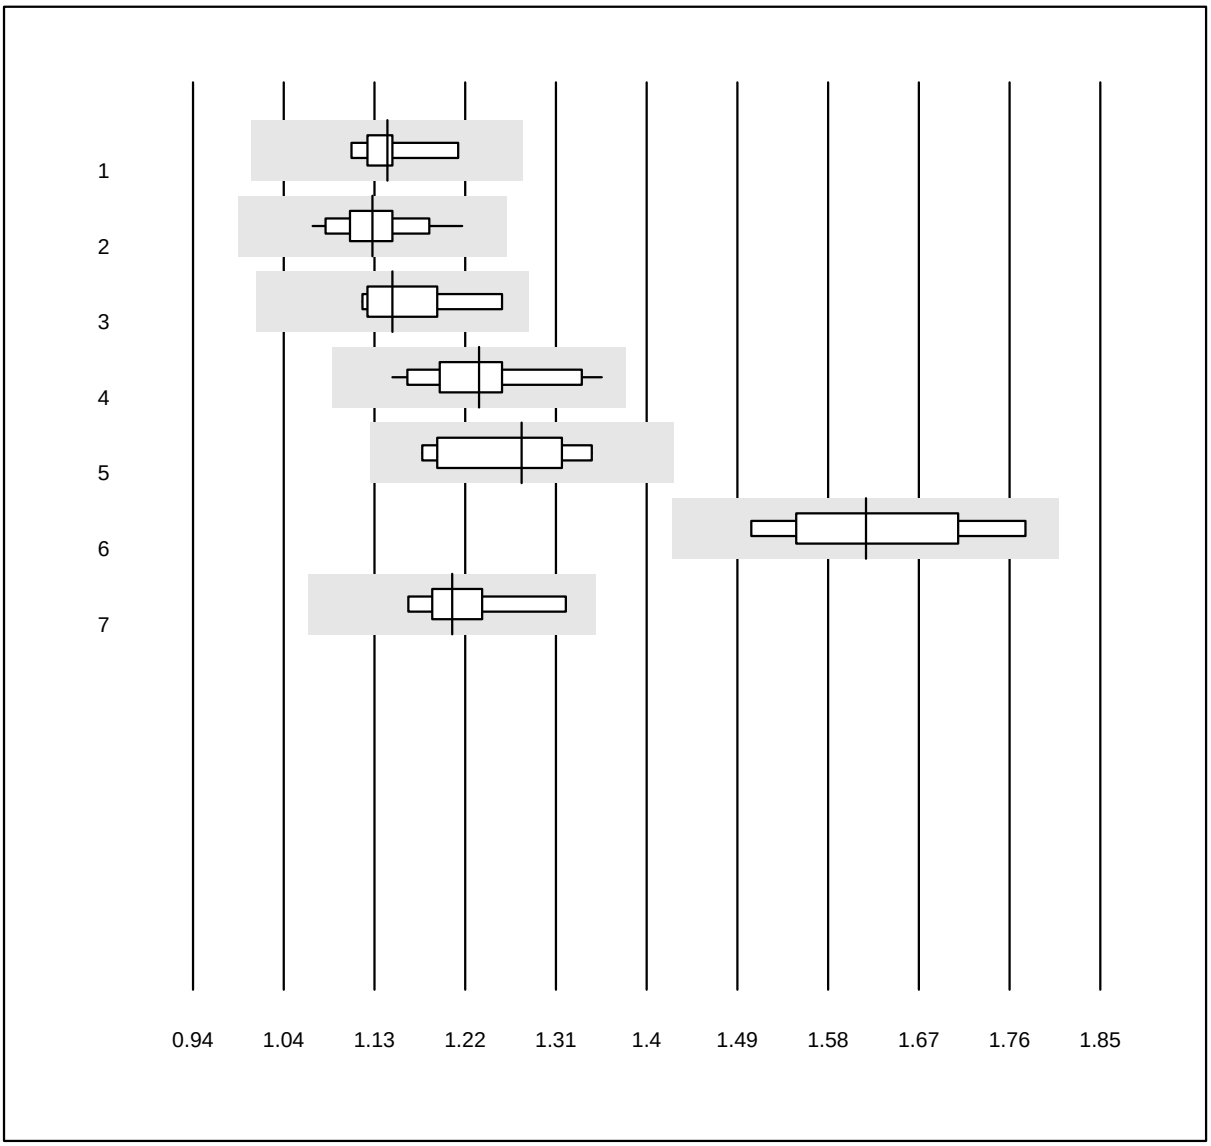


QUALAB Toleranz: 12%

Phosphates (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	8	100.0	0.0	0.0	1.1	2.6	e
2	Roche	42	100.0	0.0	0.0	1.1	3.2	e
3	Siemens	9	100.0	0.0	0.0	1.1	4.0	e
4	Fuji Dri-Chem	56	96.4	0.0	3.6	1.2	4.8	e
5	Spotchem D-Concept	10	90.0	0.0	10.0	1.3	5.0	e*
6	Piccolo	4	100.0	0.0	0.0	1.6	5.2	e*
7	Vitros	7	100.0	0.0	0.0	1.2	3.8	e

5 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Protéine 1

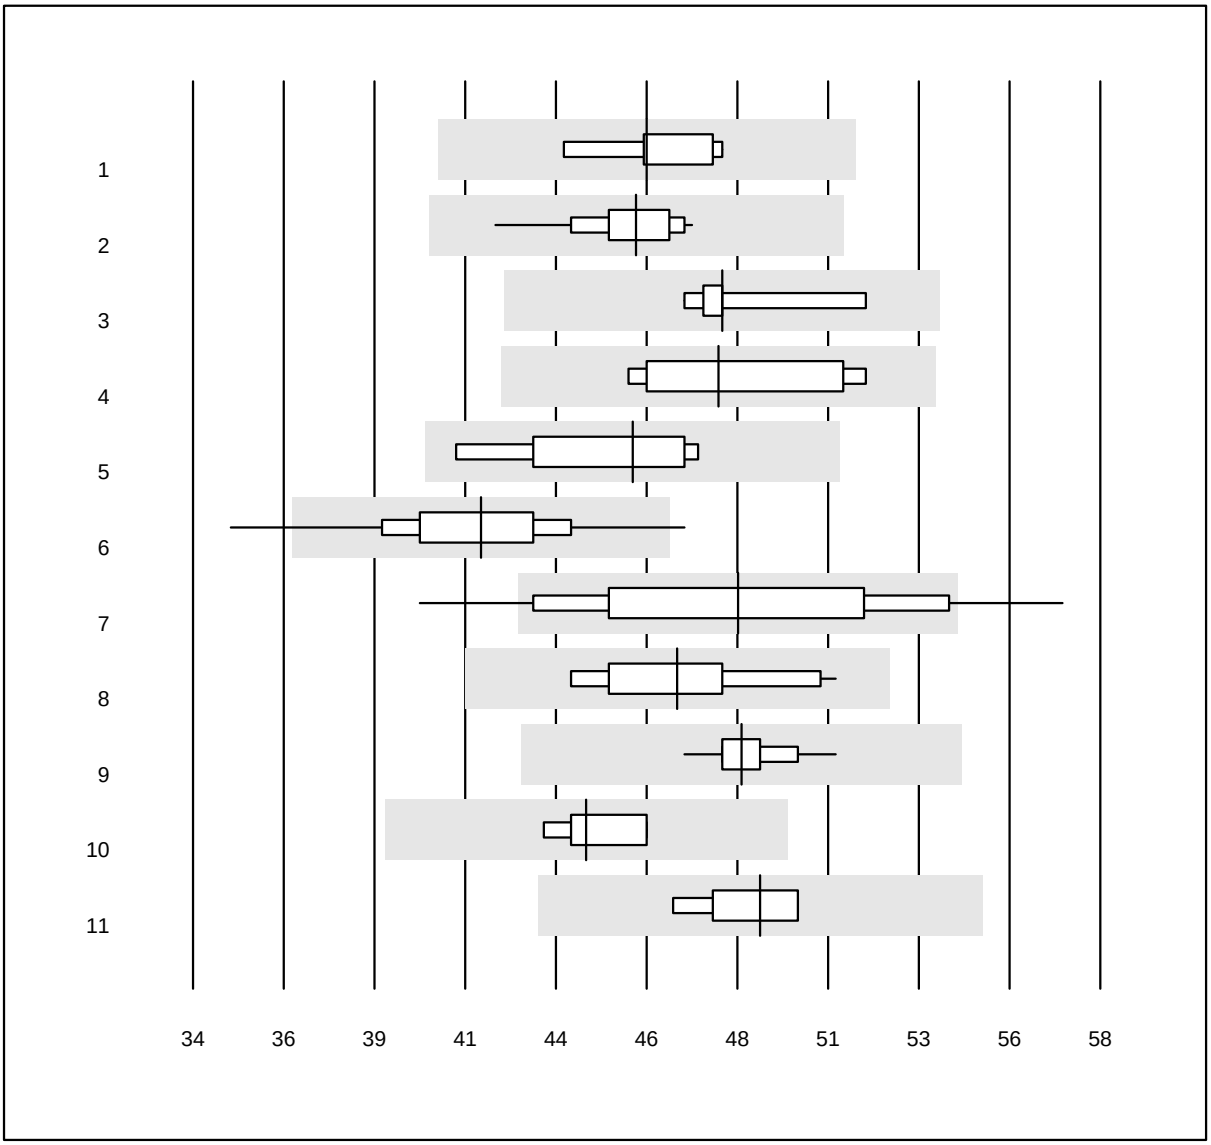


QUALAB Toleranz: 12%

Protéine (g/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	8	100.0	0.0	0.0	46.0	2.8	e
2	Roche	43	100.0	0.0	0.0	45.7	2.5	e
3	Siemens	10	90.0	0.0	10.0	48.0	2.9	e
4	Autolyser	7	100.0	0.0	0.0	47.9	5.2	e*
5	Selectra Pro	7	100.0	0.0	0.0	45.6	4.9	e*
6	Fuji Dri-Chem	183	98.4	1.1	0.5	41.6	4.5	e
7	Spotchem D-Concept	212	84.0	14.2	1.9	48.4	8.1	e
8	Spotchem SP-4430	23	100.0	0.0	0.0	46.8	4.6	e
9	Piccolo	50	100.0	0.0	0.0	48.5	1.8	e
10	Vitros	7	100.0	0.0	0.0	44.4	2.3	e
11	Skyla	6	100.0	0.0	0.0	49.0	2.7	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Protéine 2

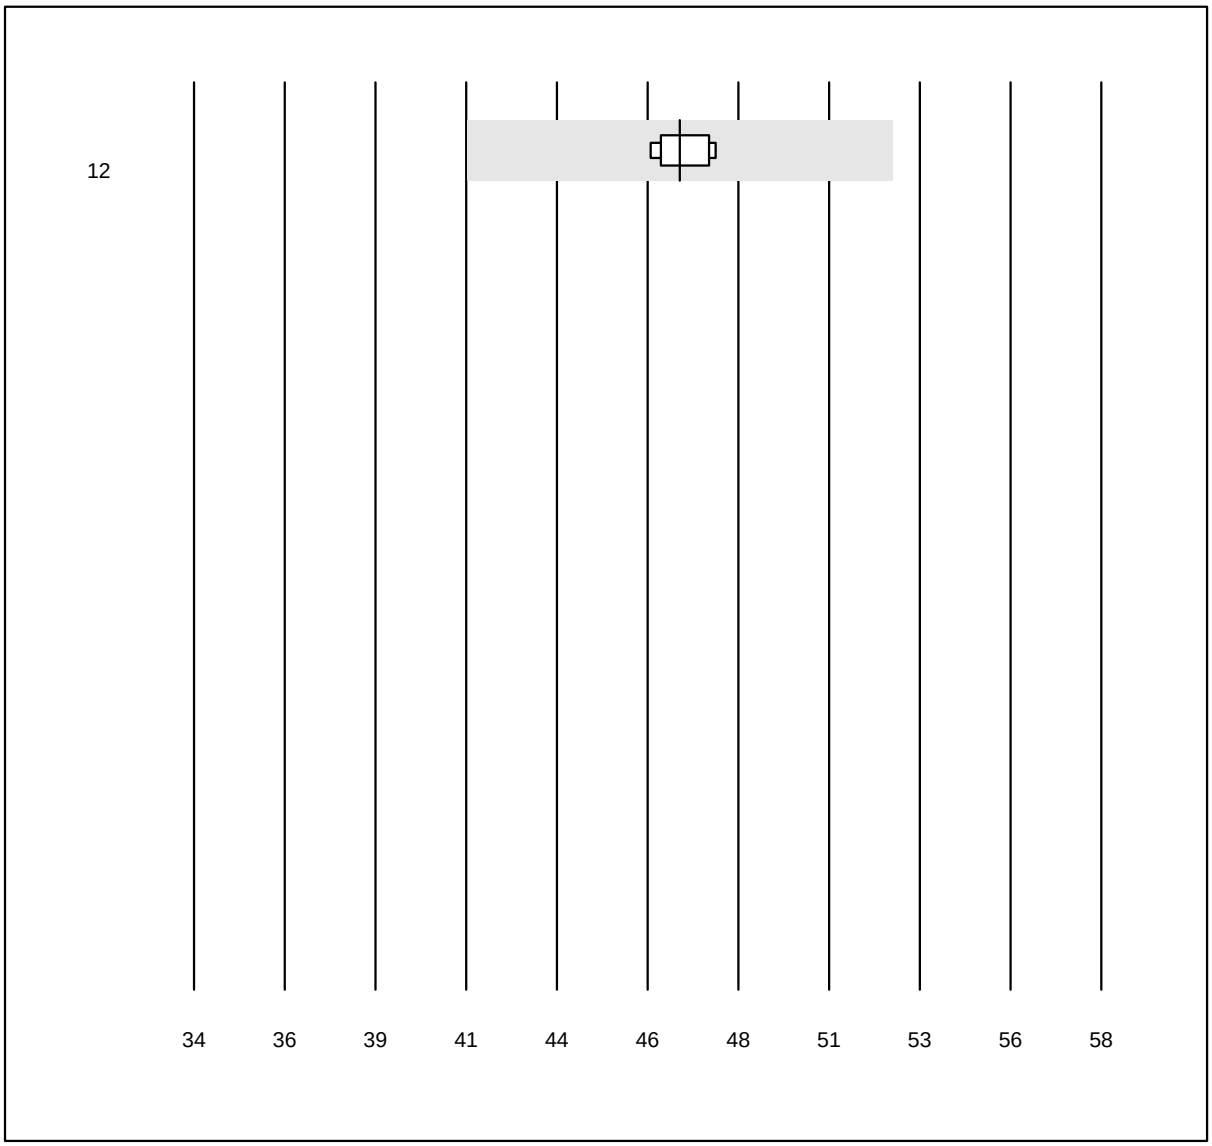


QUALAB Toleranz: 12%

Protéine (g/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
12	Seamaty	8	100.0	0.0	0.0	46.9	1.4	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Triglycérides 1

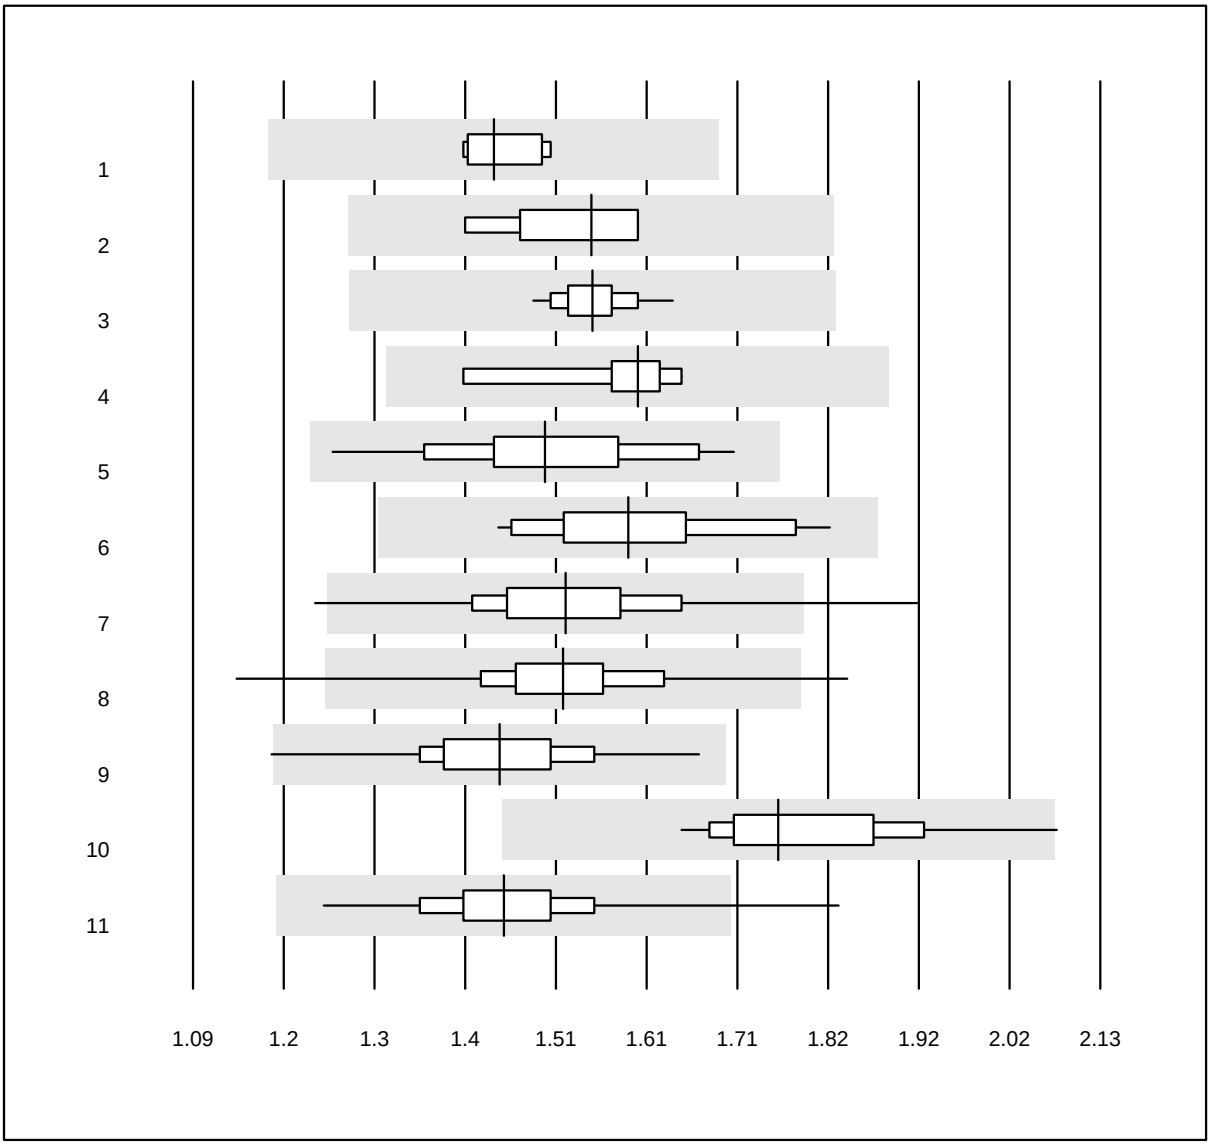


QUALAB Toleranz: 18%

Triglycérides (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	8	100.0	0.0	0.0	1.44	2.8	e
2	Beckman	5	100.0	0.0	0.0	1.55	4.7	e
3	Roche	39	100.0	0.0	0.0	1.55	2.6	e
4	Siemens	9	100.0	0.0	0.0	1.60	4.6	e
5	Autolyser	24	100.0	0.0	0.0	1.49	7.3	e
6	Selectra Pro	12	100.0	0.0	0.0	1.59	6.3	e
7	Fuji Dri-Chem	994	97.0	1.9	1.1	1.52	6.3	e
8	Spotchem D-Concept	490	97.1	0.8	2.0	1.51	5.6	e
9	Spotchem SP-4430	70	98.6	1.4	0.0	1.44	5.9	e
10	Piccolo	18	88.9	5.6	5.6	1.76	6.0	e
11	Cholestech LDX	199	98.5	1.5	0.0	1.45	5.9	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Triglycérides 2

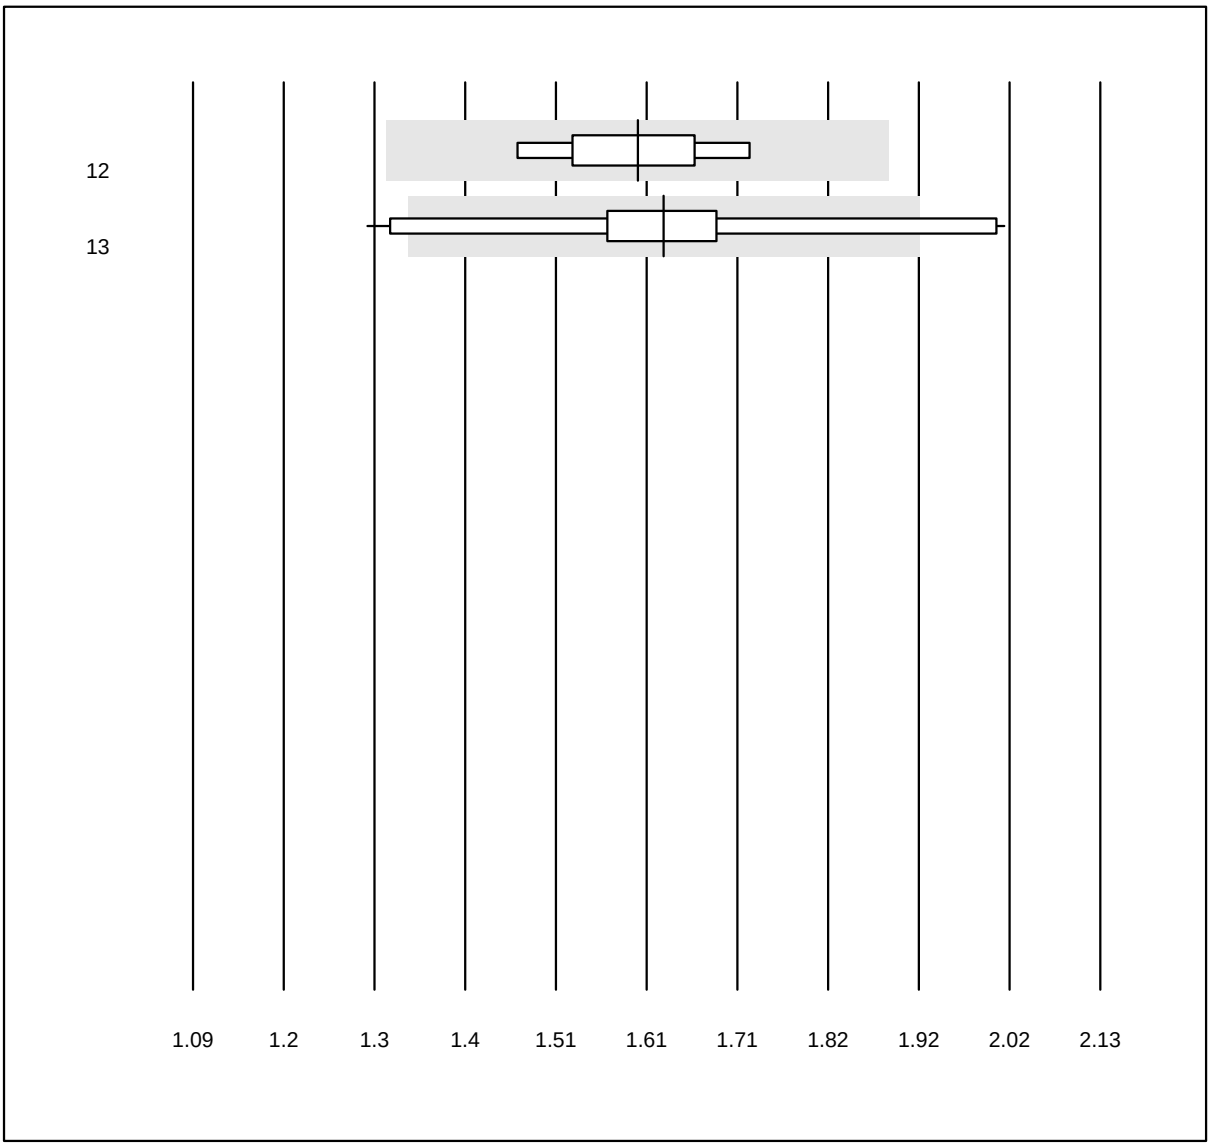


QUALAB Toleranz: 18%

Triglycérides (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
12	Vitros	5	100.0	0.0	0.0	1.60	4.9	e*
13	Seamaty	11	63.6	27.3	9.1	1.63	12.5	e*

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

HbA1c échantillon A 1

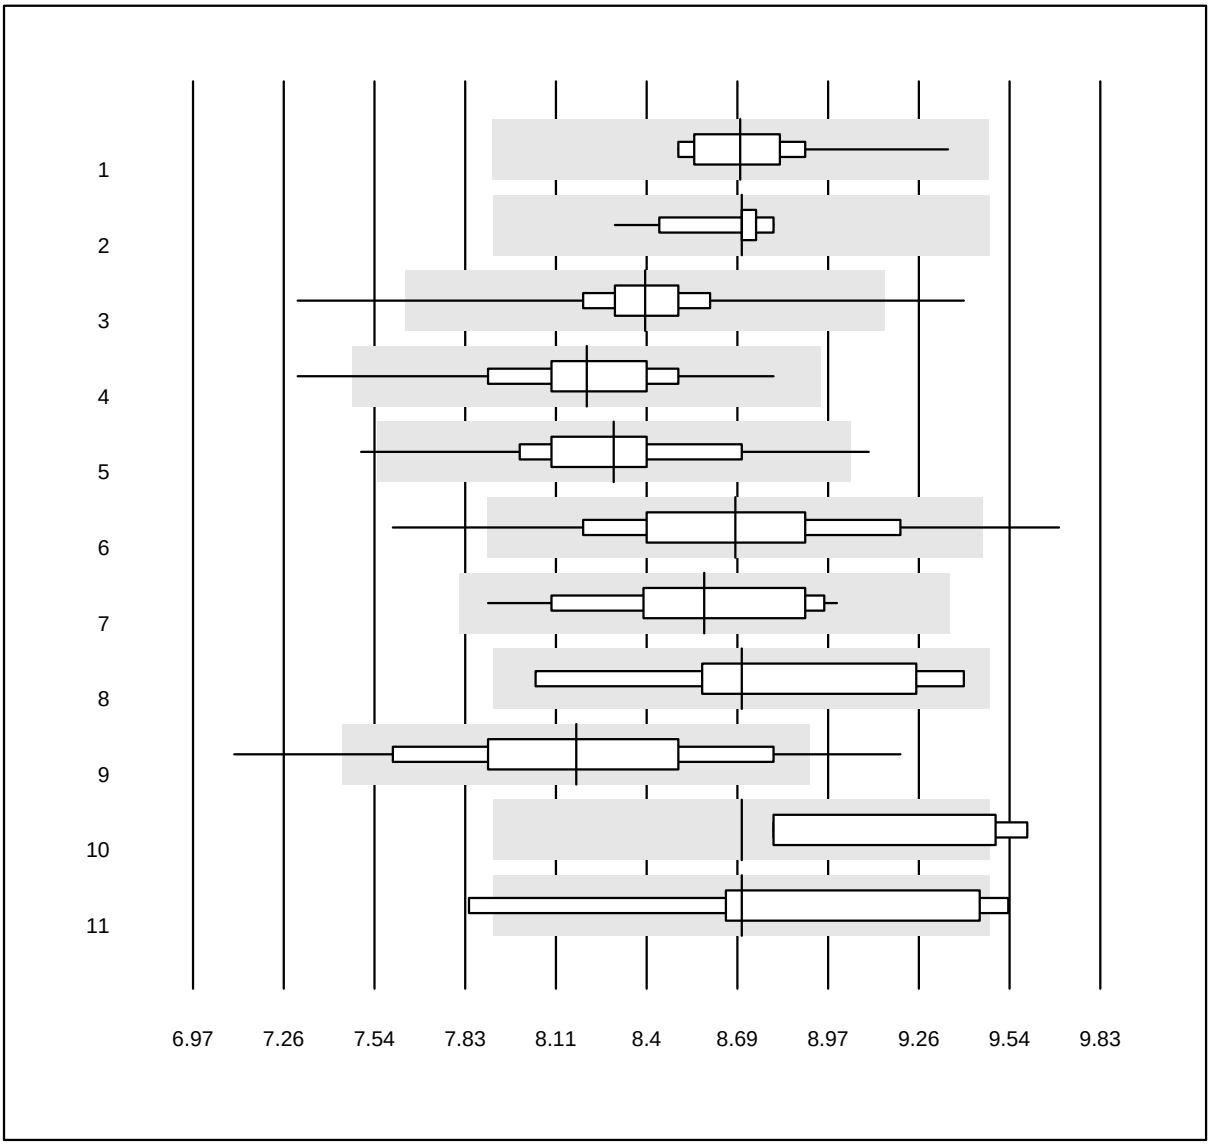


QUALAB Toleranz: 9%

HbA1c échantillon A (%)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	26	96.2	0.0	3.8	8.7	2.2	e
2	HPLC	16	100.0	0.0	0.0	8.7	1.4	e
3	Afinion	624	98.4	0.5	1.1	8.4	2.2	e
4	Cobas b101/Click	258	98.4	0.8	0.8	8.2	2.9	e
5	DCA Vantage	156	96.2	1.3	2.6	8.3	3.0	e
6	AFIAS	162	91.4	5.6	3.1	8.7	4.6	e
7	Celltac chemi	43	100.0	0.0	0.0	8.6	3.9	e
8	LumiraDx	4	100.0	0.0	0.0	8.7	4.4	c*
9	A1c Now	202	84.7	8.9	6.4	8.2	5.5	e
10	Quick Read go	9	77.8	22.2	0.0	8.7	3.7	c*
11	Eurolyser	6	66.7	16.7	16.7	8.7	5.8	c*

5 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

HbA1c échantillon A 2

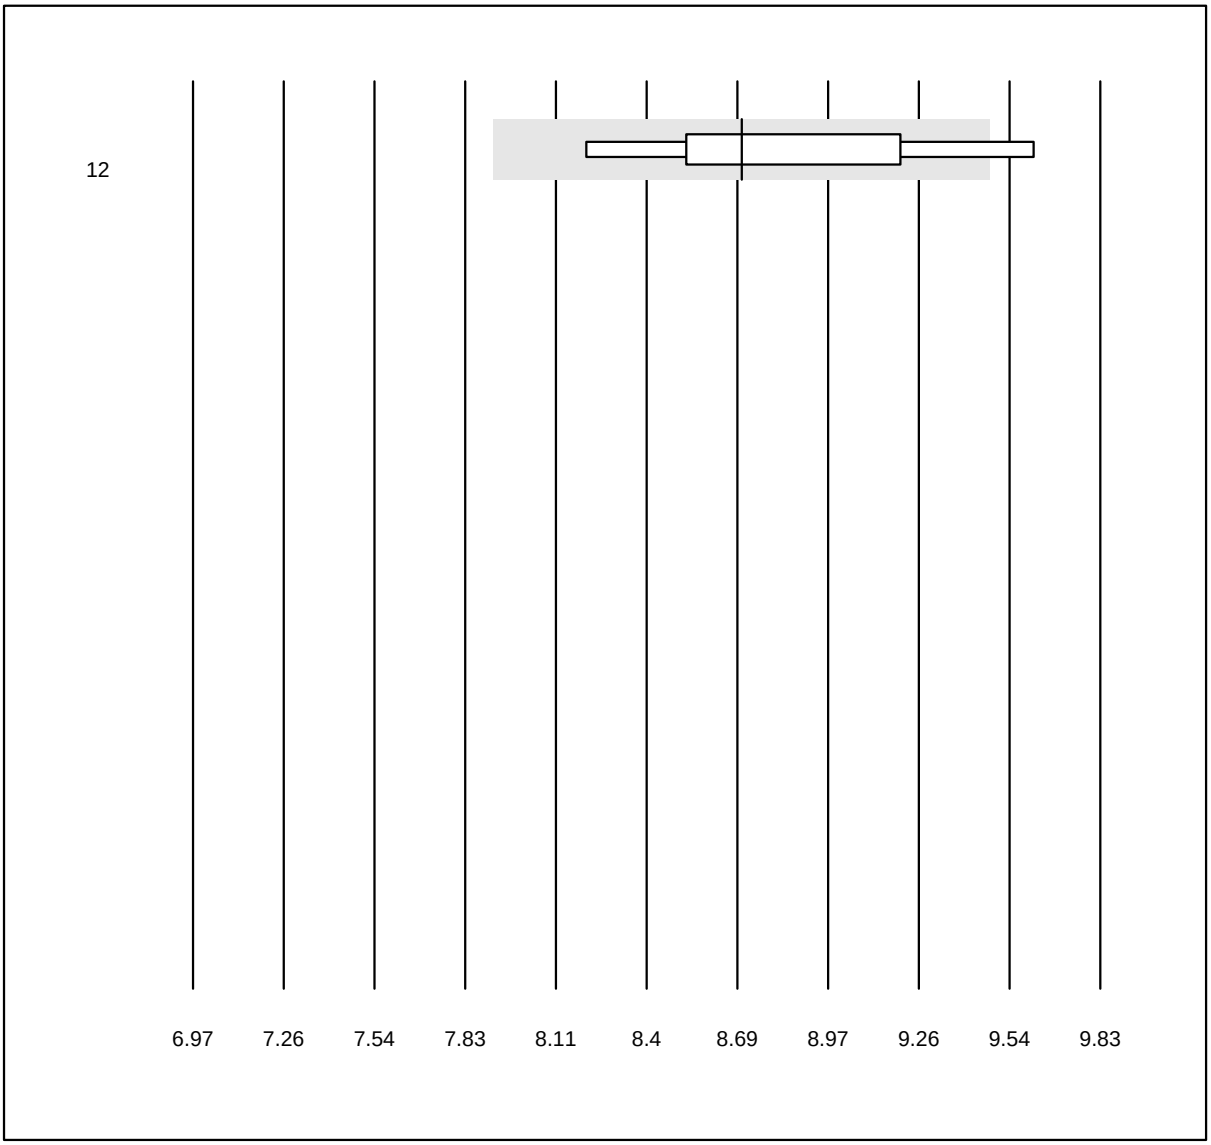


QUALAB Toleranz: 9%

HbA1c échantillon A (%)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
12	Andere	6	83.3	16.7	0.0	8.7	4.9	c*

5 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

HbA1c échantillon B

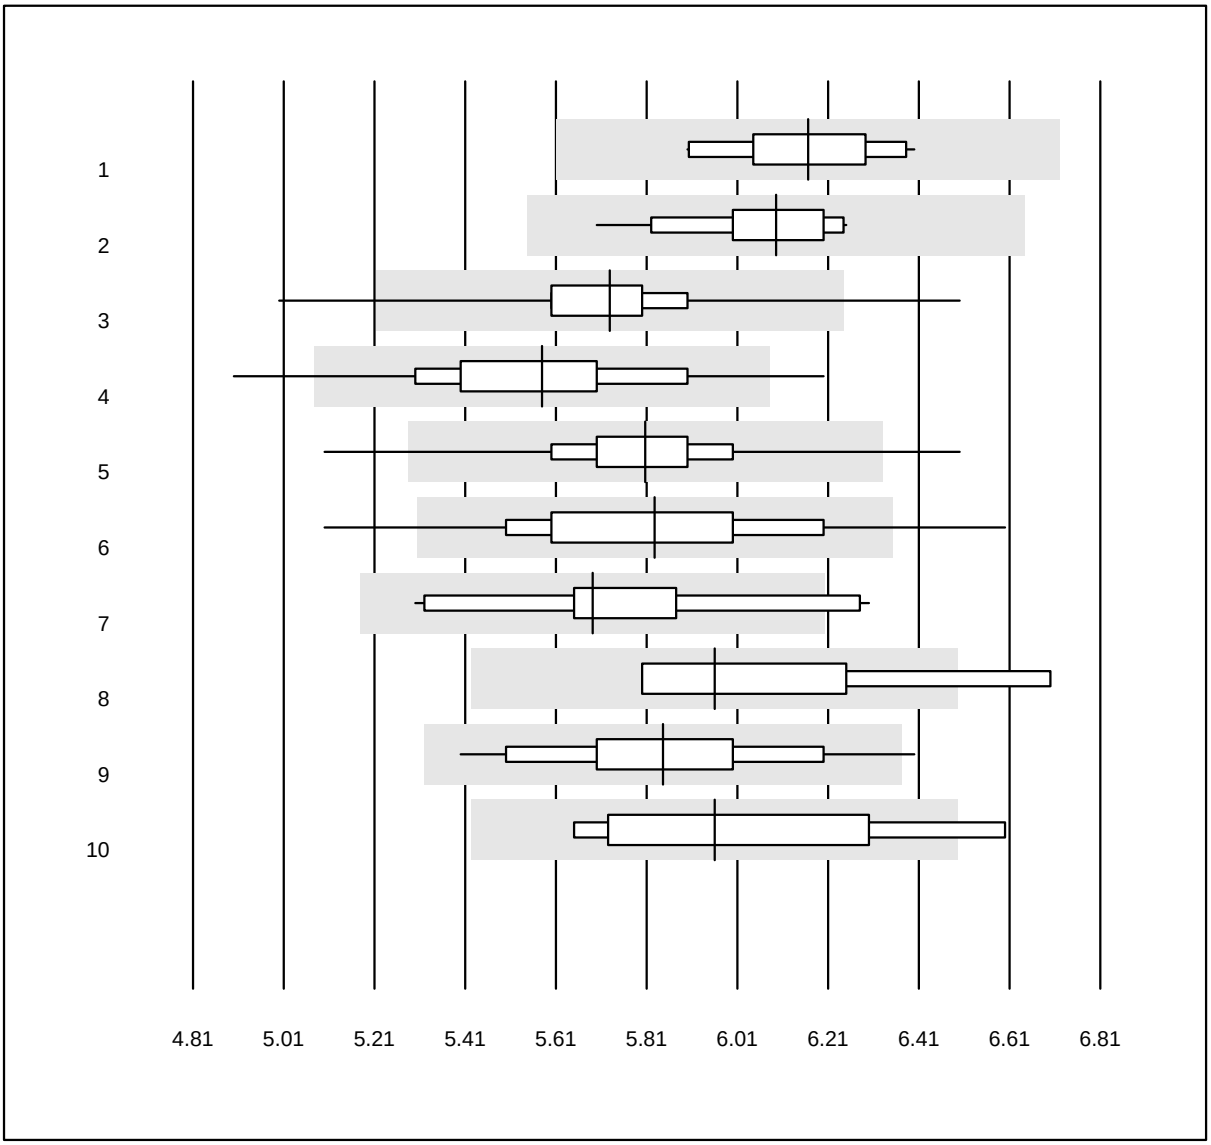


QUALAB Toleranz: 9%

HbA1c échantillon B (%)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	23	95.7	0.0	4.3	6.2	2.5	e
2	HPLC	15	100.0	0.0	0.0	6.1	2.3	e
3	Afinion	661	98.3	0.6	1.1	5.7	2.4	e
4	Cobas b101/Click	223	97.3	2.7	0.0	5.6	3.9	e
5	DCA Vantage	169	97.0	2.4	0.6	5.8	3.2	e
6	AFIAS	242	90.1	9.1	0.8	5.8	5.1	e
7	A1c Now	13	69.2	7.7	23.1	5.7	4.8	e*
8	Quick Read go	5	80.0	20.0	0.0	6.0	4.9	c*
9	Celltac chemi	35	94.3	2.9	2.9	5.8	4.0	e
10	Andere	4	100.0	0.0	0.0	6.0	5.2	c*

7 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

pO2

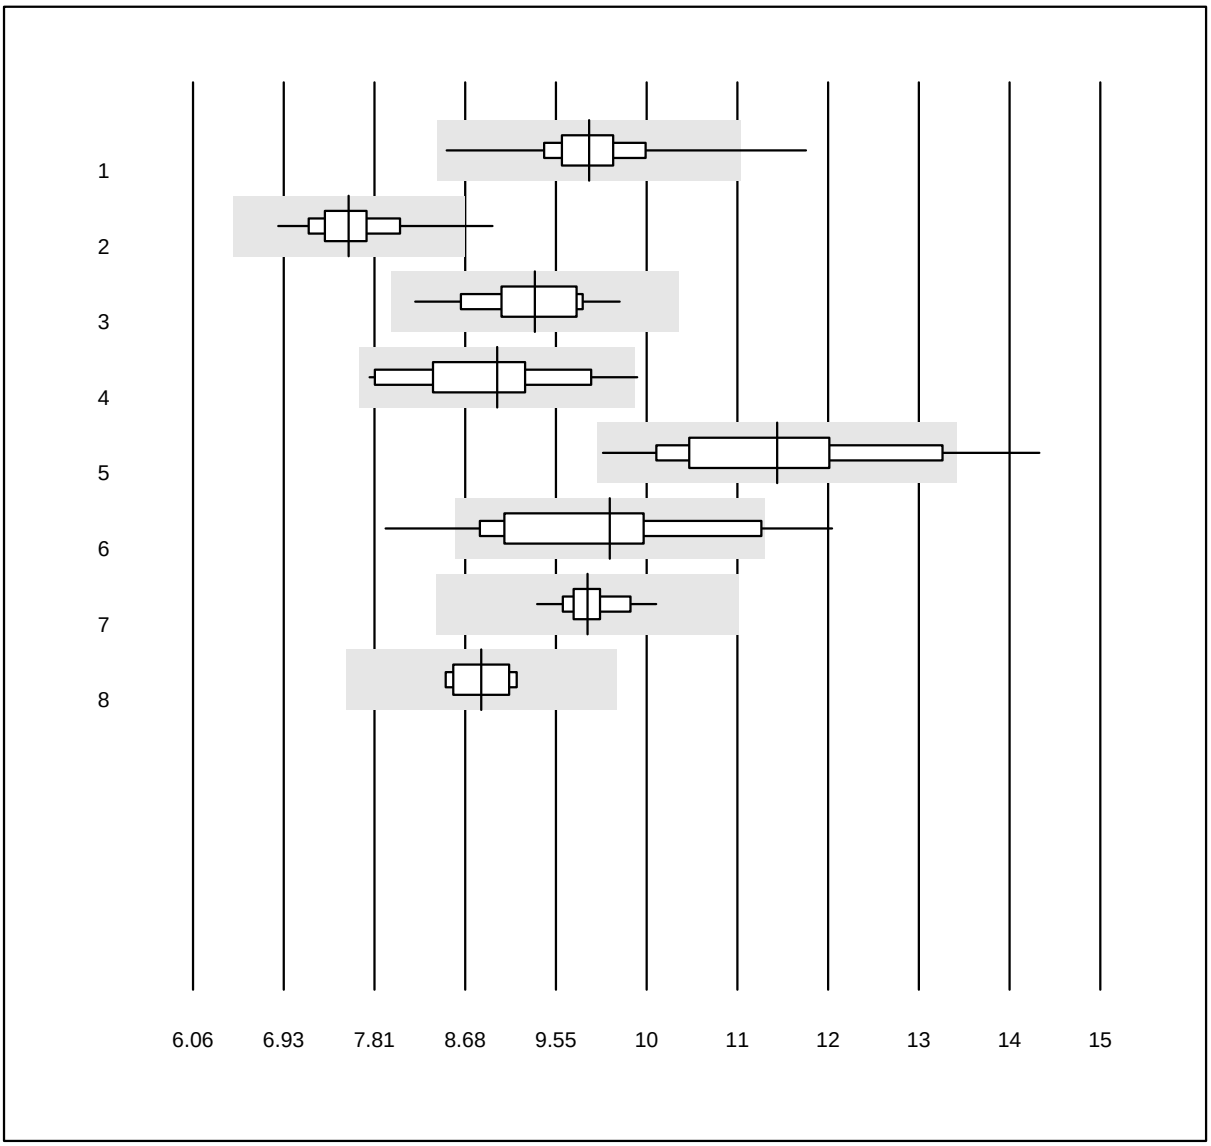


QUALAB Toleranz: 15%

pO2 (kPa)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	ABL700/800	122	93.4	2.5	4.1	9.96	5.0	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	176	92.6	2.3	5.1	7.59	5.0	e
3	GEM	20	95.0	0.0	5.0	9.43	5.3	e
4	Cobas b 123	18	88.9	5.6	5.6	9.06	7.6	e
5	iStat	57	84.2	8.8	7.0	11.82	8.9	e
6	EPOC	61	80.3	8.2	11.5	10.17	10.0	e
7	RAPIDPoint 500	29	100.0	0.0	0.0	9.95	2.6	e
8	IL	4	100.0	0.0	0.0	8.90	3.3	e

4 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

pCO2

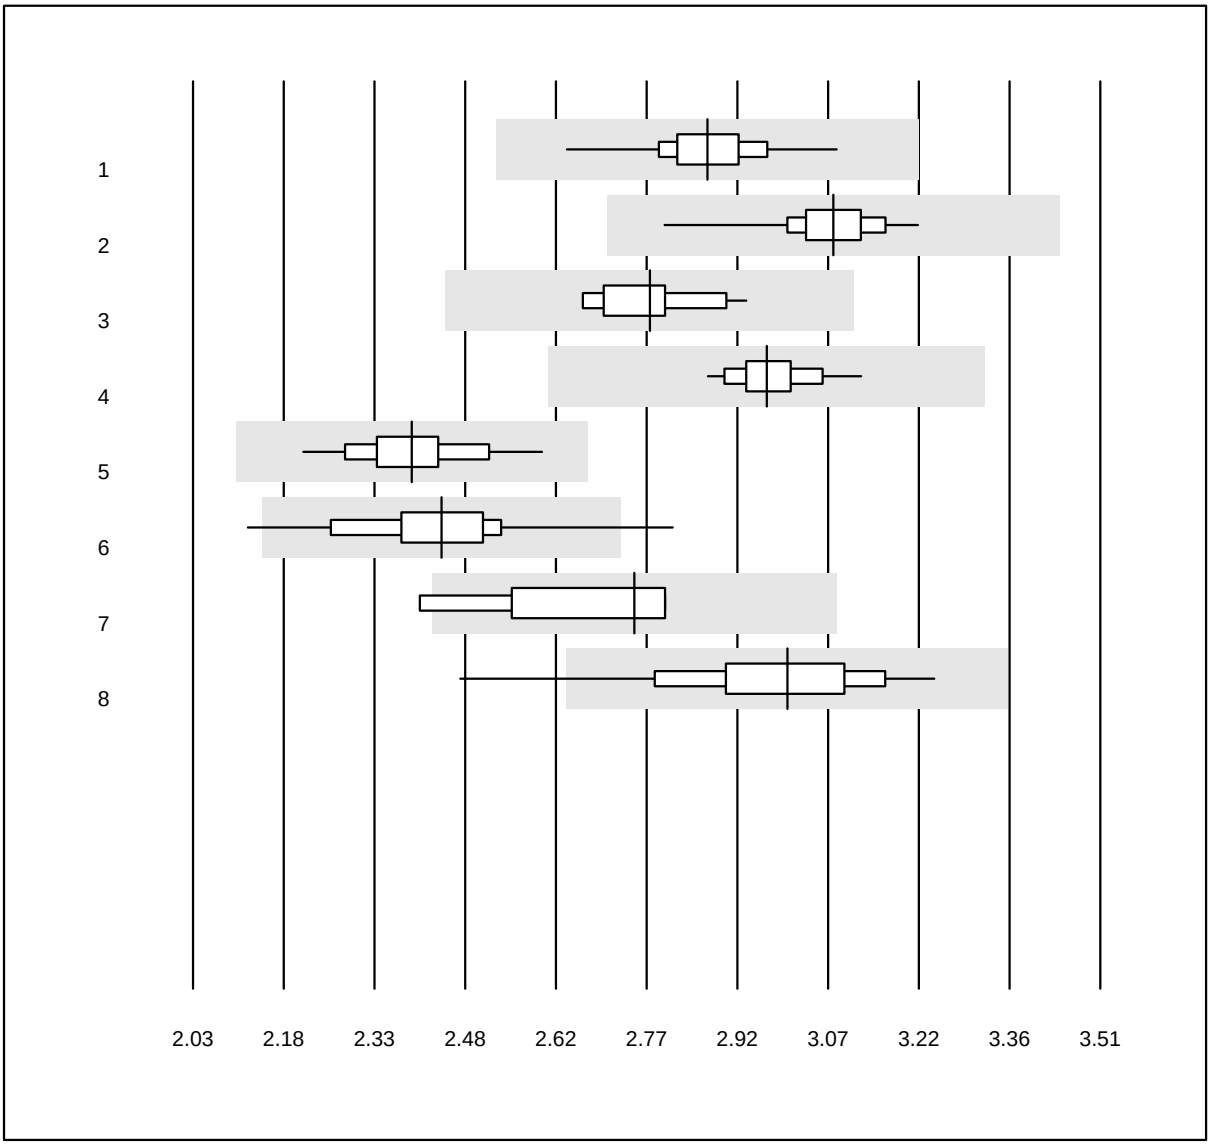


QUALAB Toleranz: 12%

pCO2 (kPa)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	ABL700/800	122	100.0	0.0	0.0	2.87	2.7	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	175	99.4	0.0	0.6	3.07	2.2	e
3	GEM	20	100.0	0.0	0.0	2.78	2.9	e
4	Cobas b 123	18	100.0	0.0	0.0	2.97	2.1	e
5	iStat	59	98.3	0.0	1.7	2.39	3.6	e
6	EPOC	61	90.2	3.3	6.6	2.44	5.2	e
7	IL	4	100.0	0.0	0.0	2.75	5.2	e*
8	RAPIDPoint 500	30	96.7	3.3	0.0	3.00	5.2	e

4 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

pH

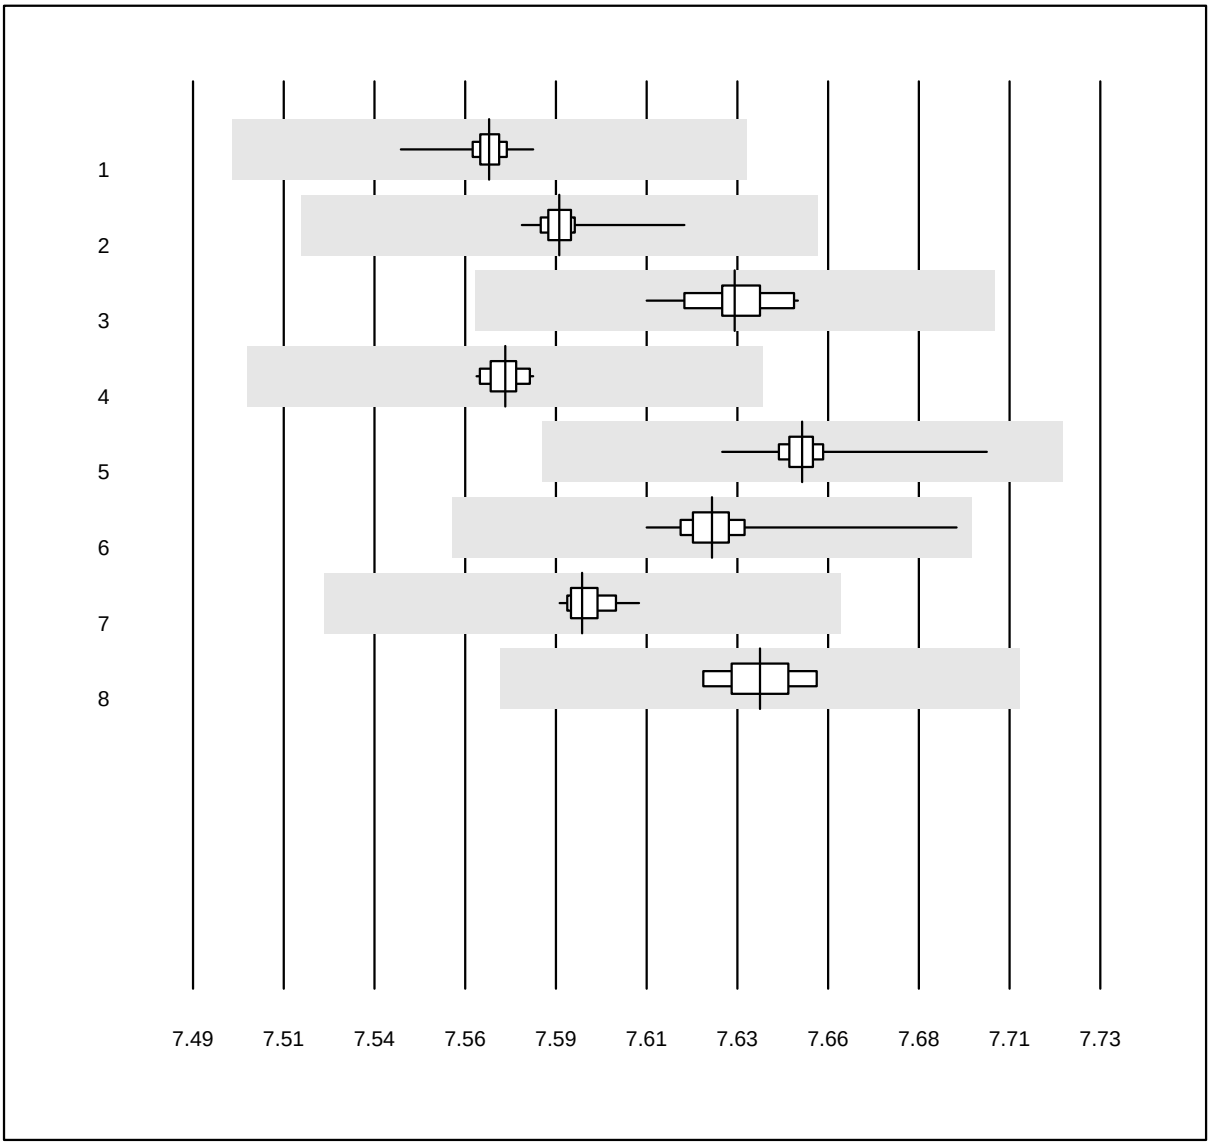


QUALAB Toleranz: 0%

pH ()

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	ABL700/800	121	100.0	0.0	0.0	7.57	0.1	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	177	100.0	0.0	0.0	7.59	0.1	e
3	GEM	20	100.0	0.0	0.0	7.63	0.1	e
4	Cobas b 123	18	100.0	0.0	0.0	7.57	0.1	e
5	iStat	62	100.0	0.0	0.0	7.65	0.1	e
6	EPOC	61	98.4	0.0	1.6	7.63	0.1	e
7	RAPIDPoint 500	30	100.0	0.0	0.0	7.59	0.1	e
8	IL	4	100.0	0.0	0.0	7.64	0.1	e

5 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Hémoglobine BG

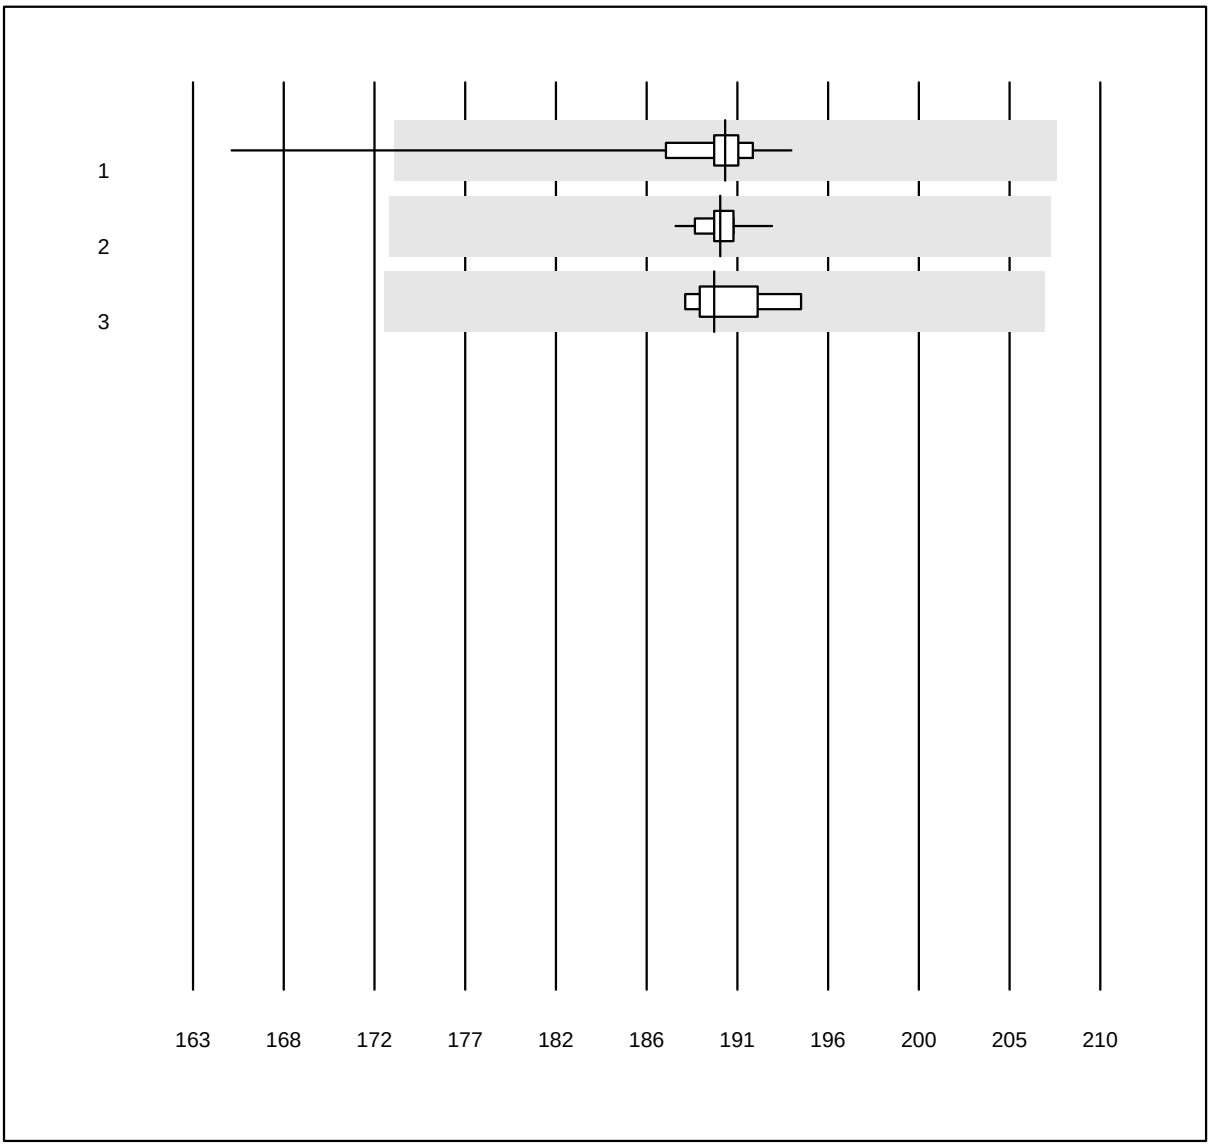


QUALAB Toleranz: 9%

Hémoglobine BG (g/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	ABL700/800	115	98.3	0.9	0.9	190.6	2.2	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	162	99.4	0.0	0.6	190.3	0.5	e
3	ABL80 FLEX CO-OX / OSM	4	100.0	0.0	0.0	190.0	0.9	e

Bilirubine OR

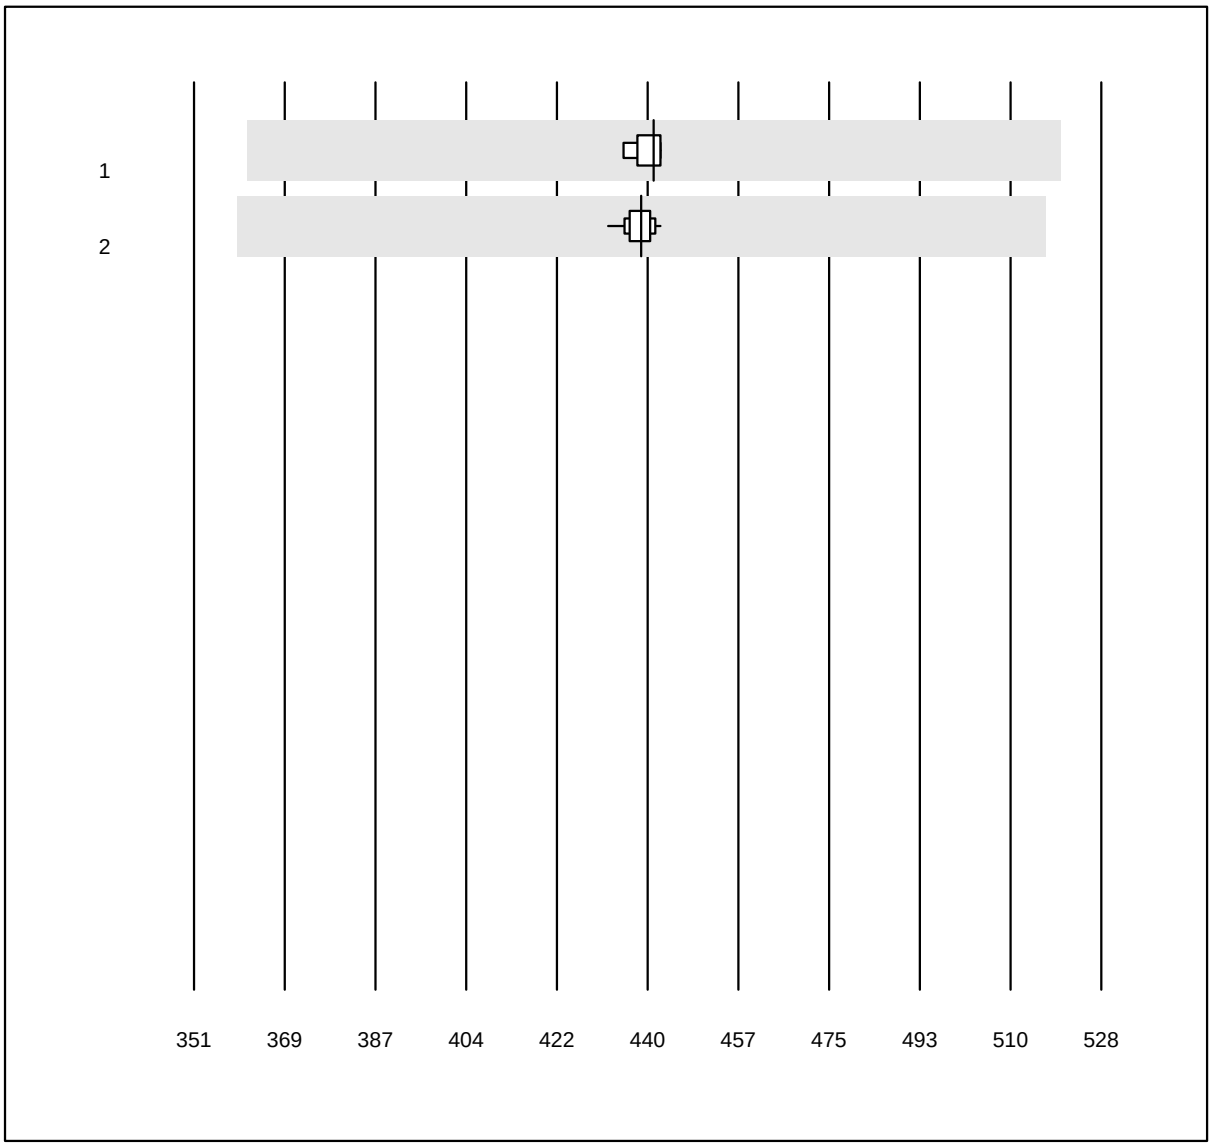


QUALAB Toleranz: 18%

Bilirubine OR (µmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	ABL700/800	5	100.0	0.0	0.0	440.7	0.6	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	35	100.0	0.0	0.0	438.2	0.5	e

FO2Hb OR

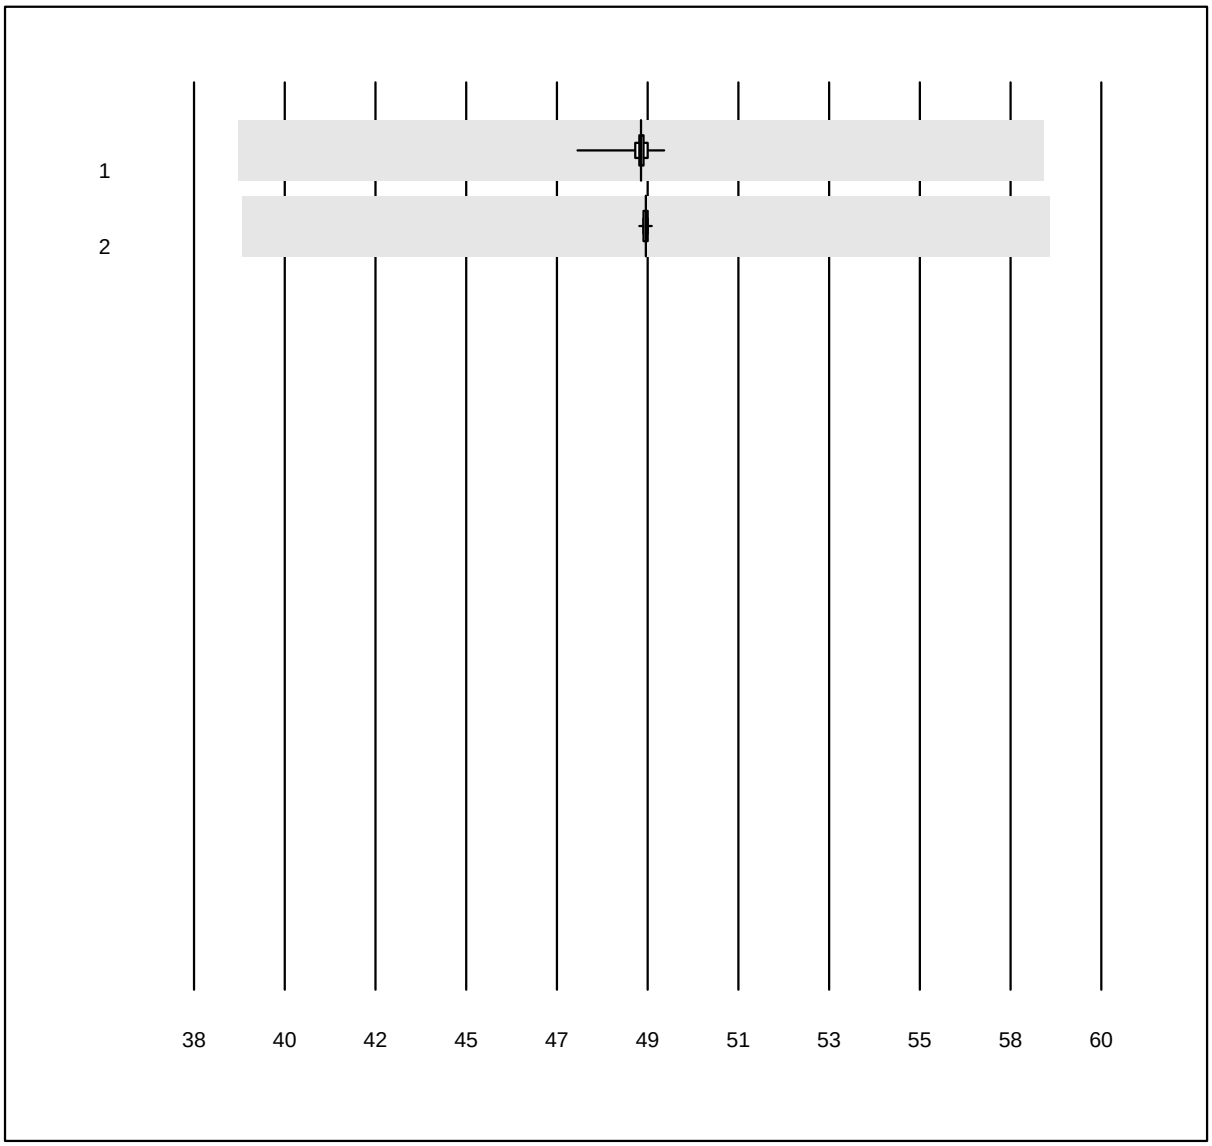


MQ Toleranz: 20%

FO2Hb OR (%)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	ABL700/800	101	99.0	0.0	1.0	48.840	0.4	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	151	99.3	0.0	0.7	48.956	0.1	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

FCOHb OR

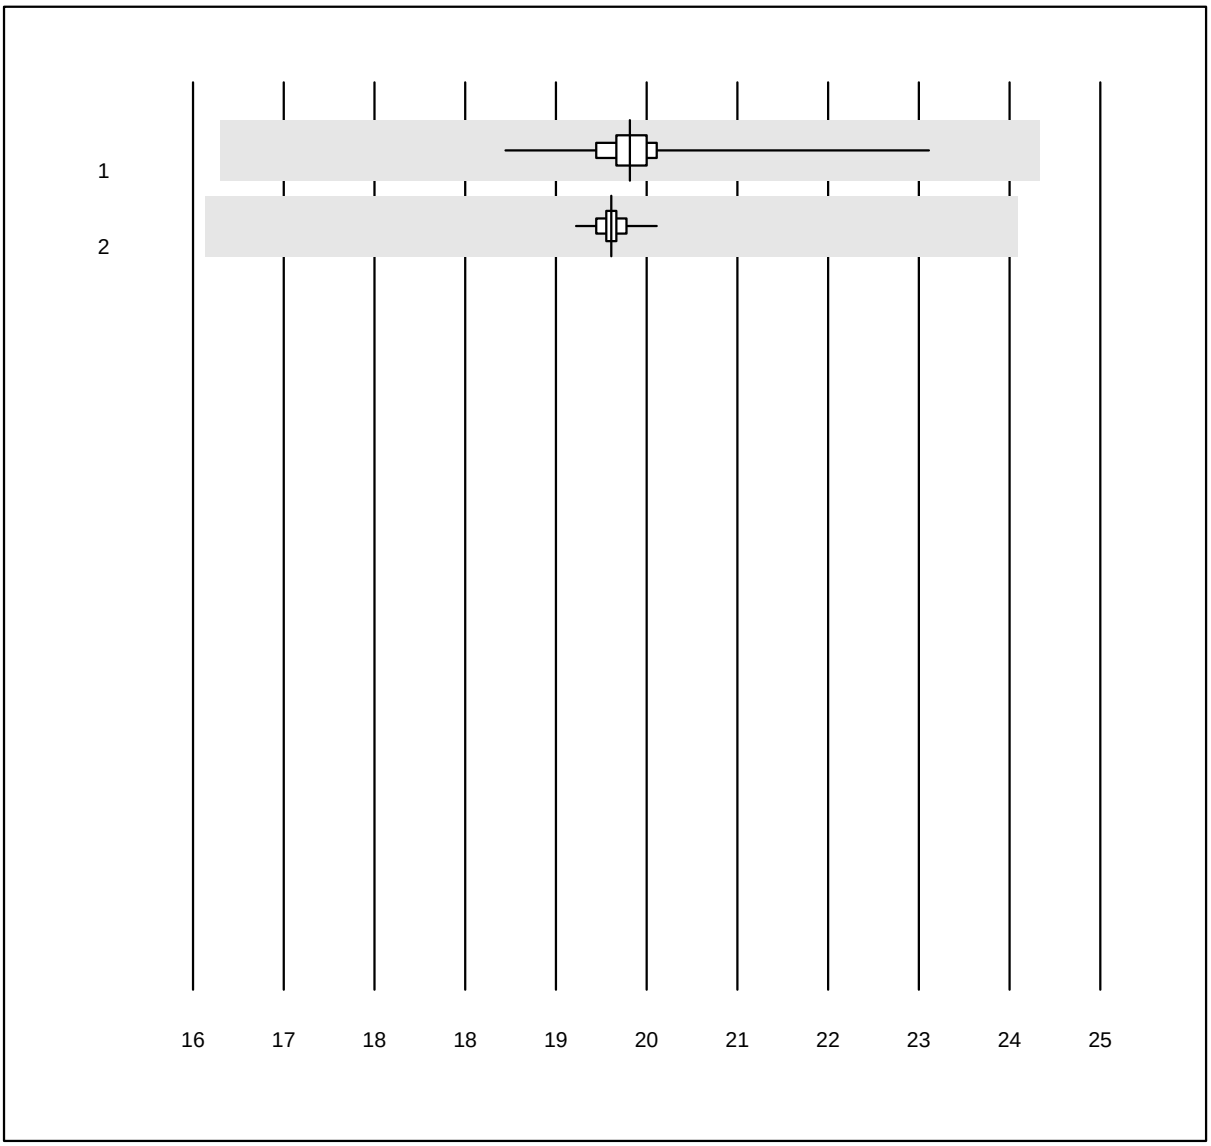


MQ Toleranz: 20%

FCOHb OR (%)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	ABL700/800	102	98.0	0.0	2.0	20.334	2.1	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	154	98.7	0.0	1.3	20.149	0.6	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

FMetHb OR

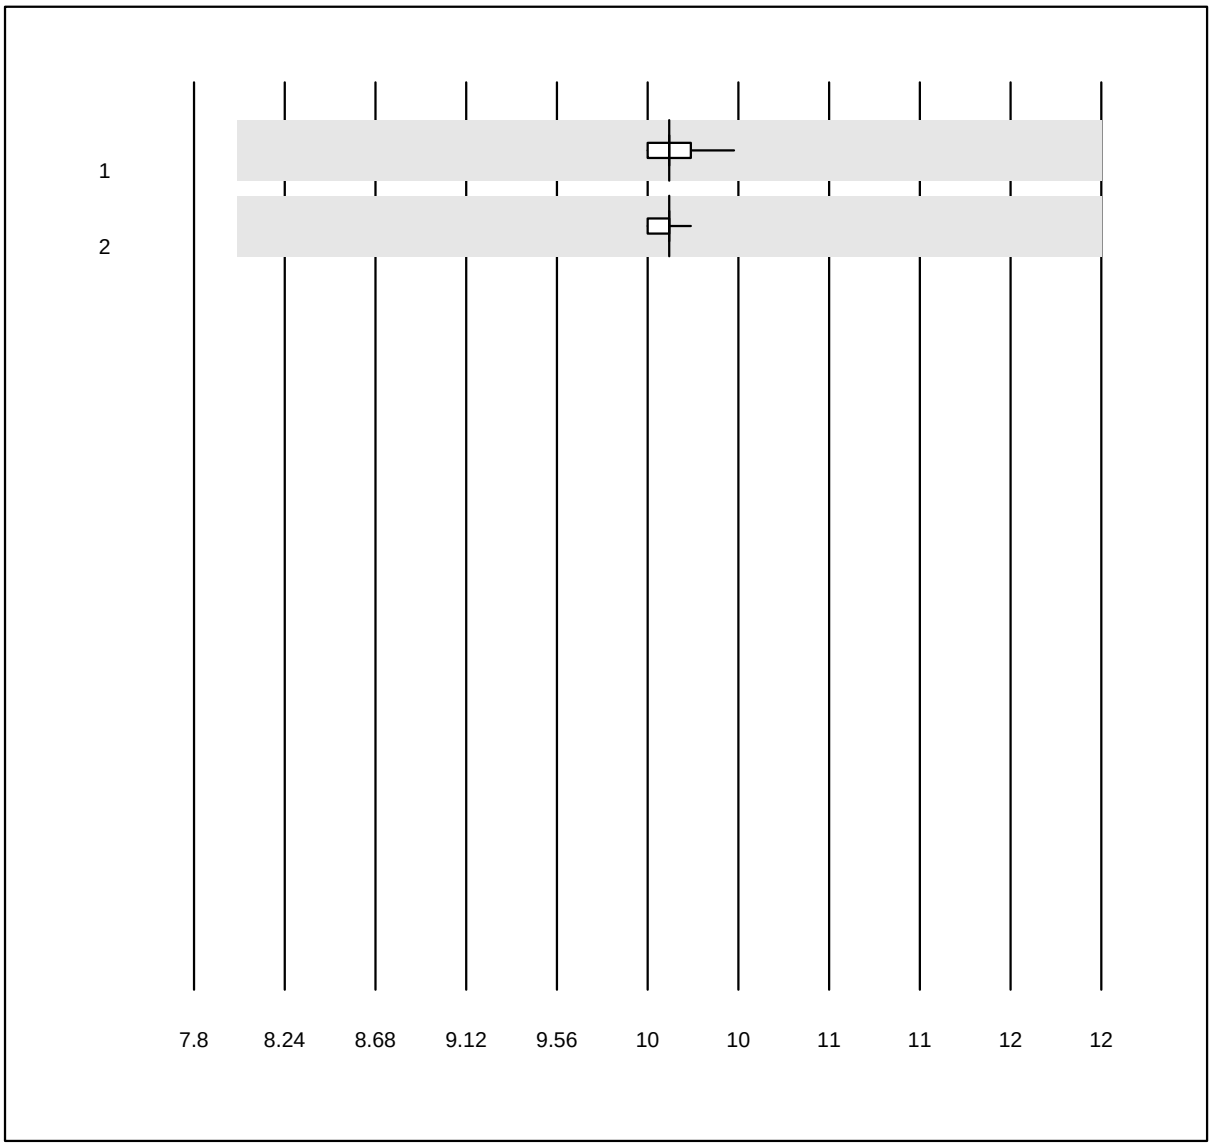


MQ Toleranz: 20%

FMetHb OR (%)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	ABL700/800	102	100.0	0.0	0.0	10.000	0.7	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	152	100.0	0.0	0.0	10.000	0.4	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

FHbF OR

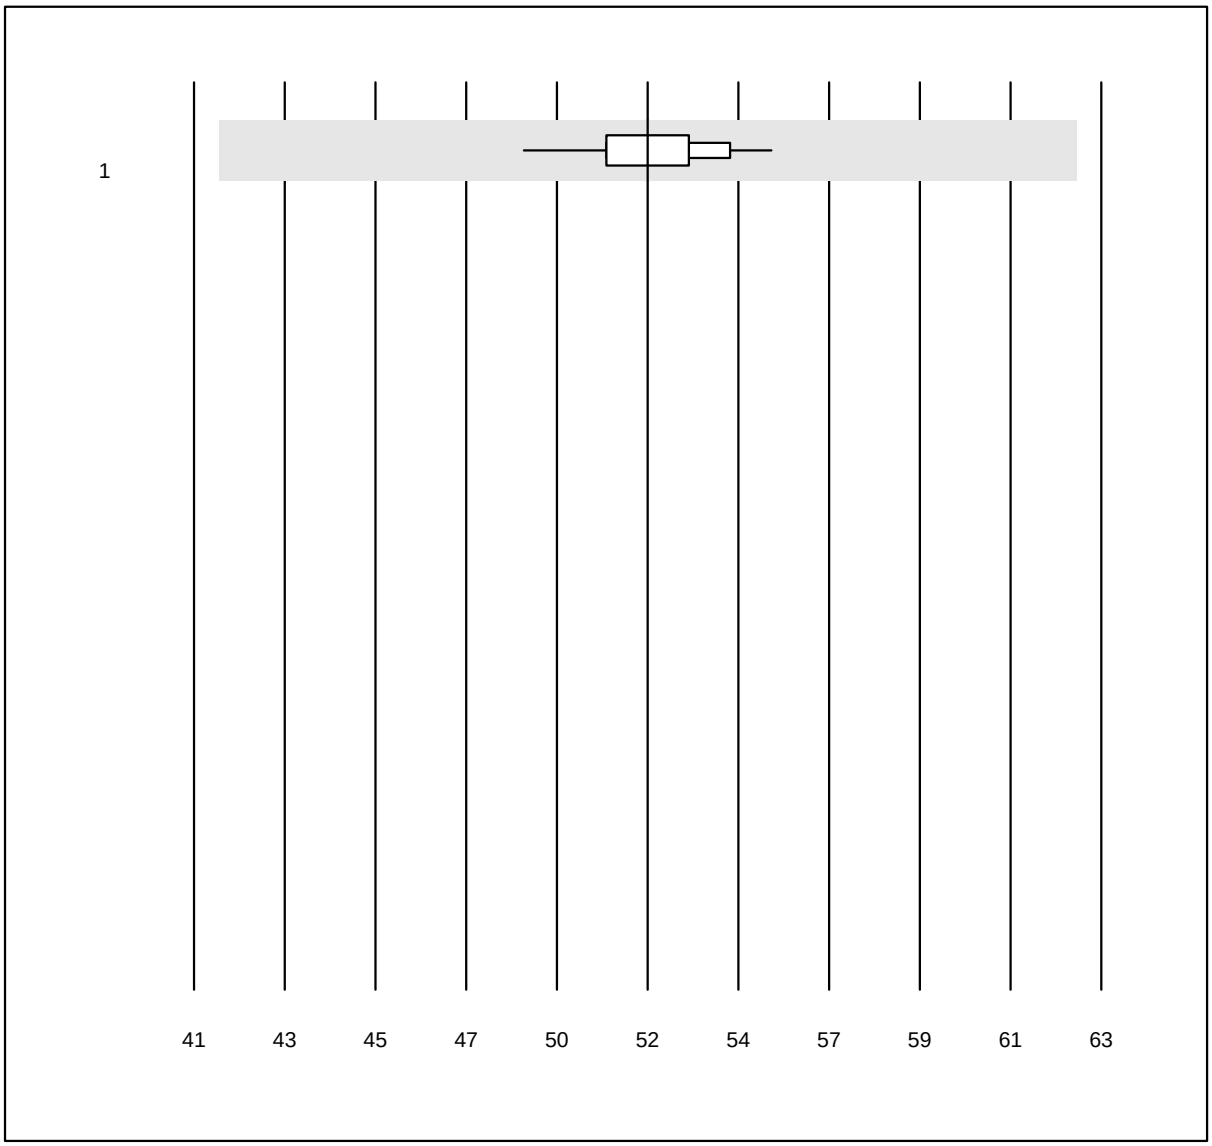


MQ Toleranz: 20%

FHbF OR (%)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	ABL90 FLEX / PLUS	37	100.0	0.0	0.0	52.000	2.5	e

FHHb

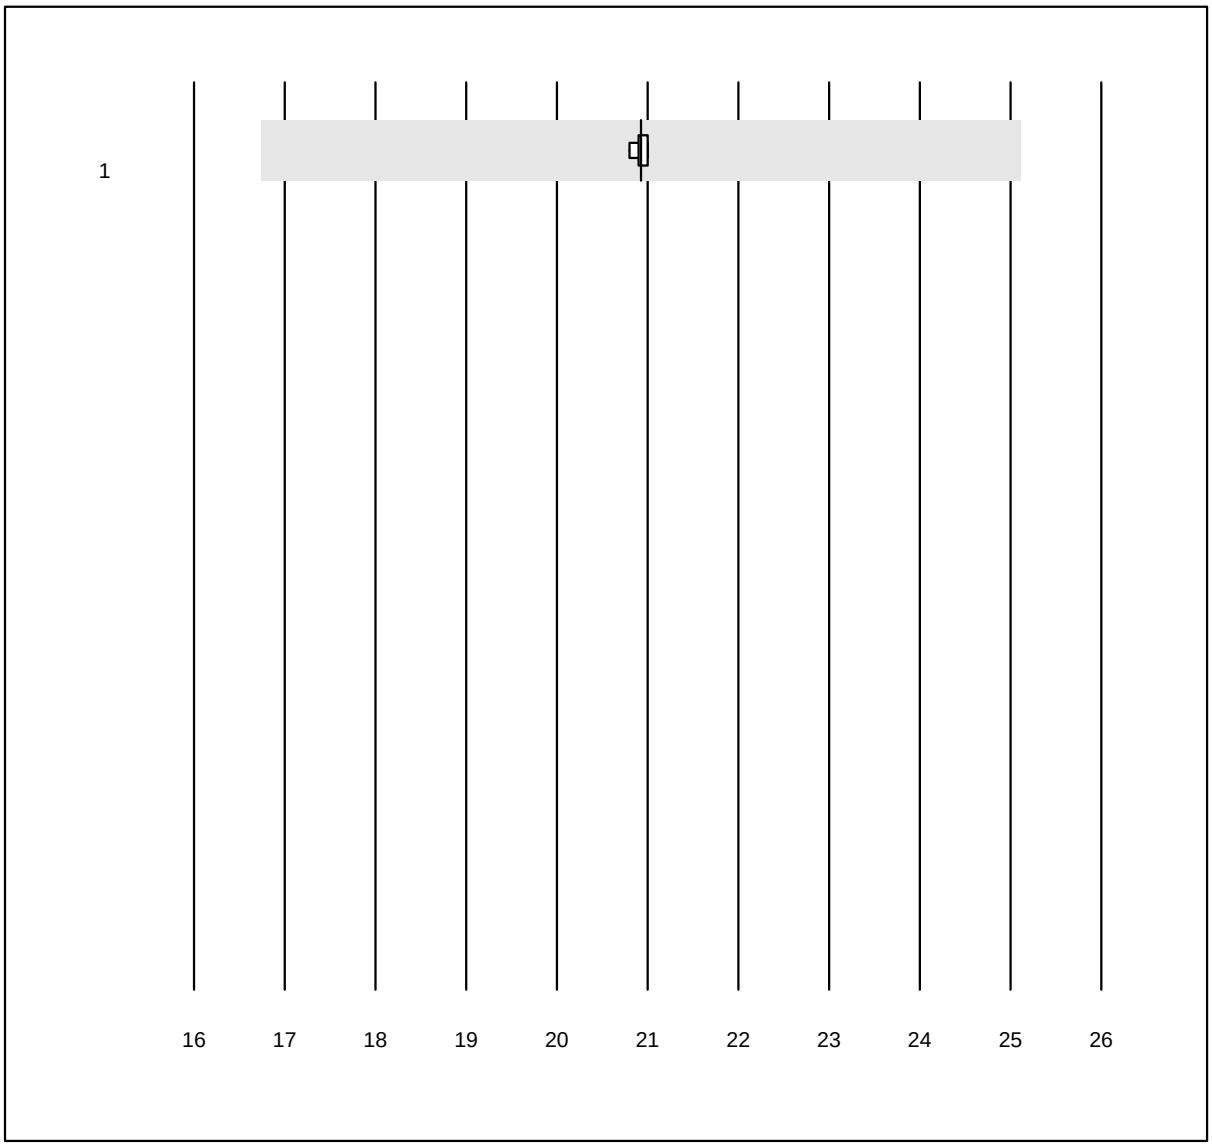


MQ Toleranz: 20%

FHHb (%)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	ABL90 FLEX / PLUS	16	100.0	0.0	0.0	20.927	0.3	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

sO2 OR

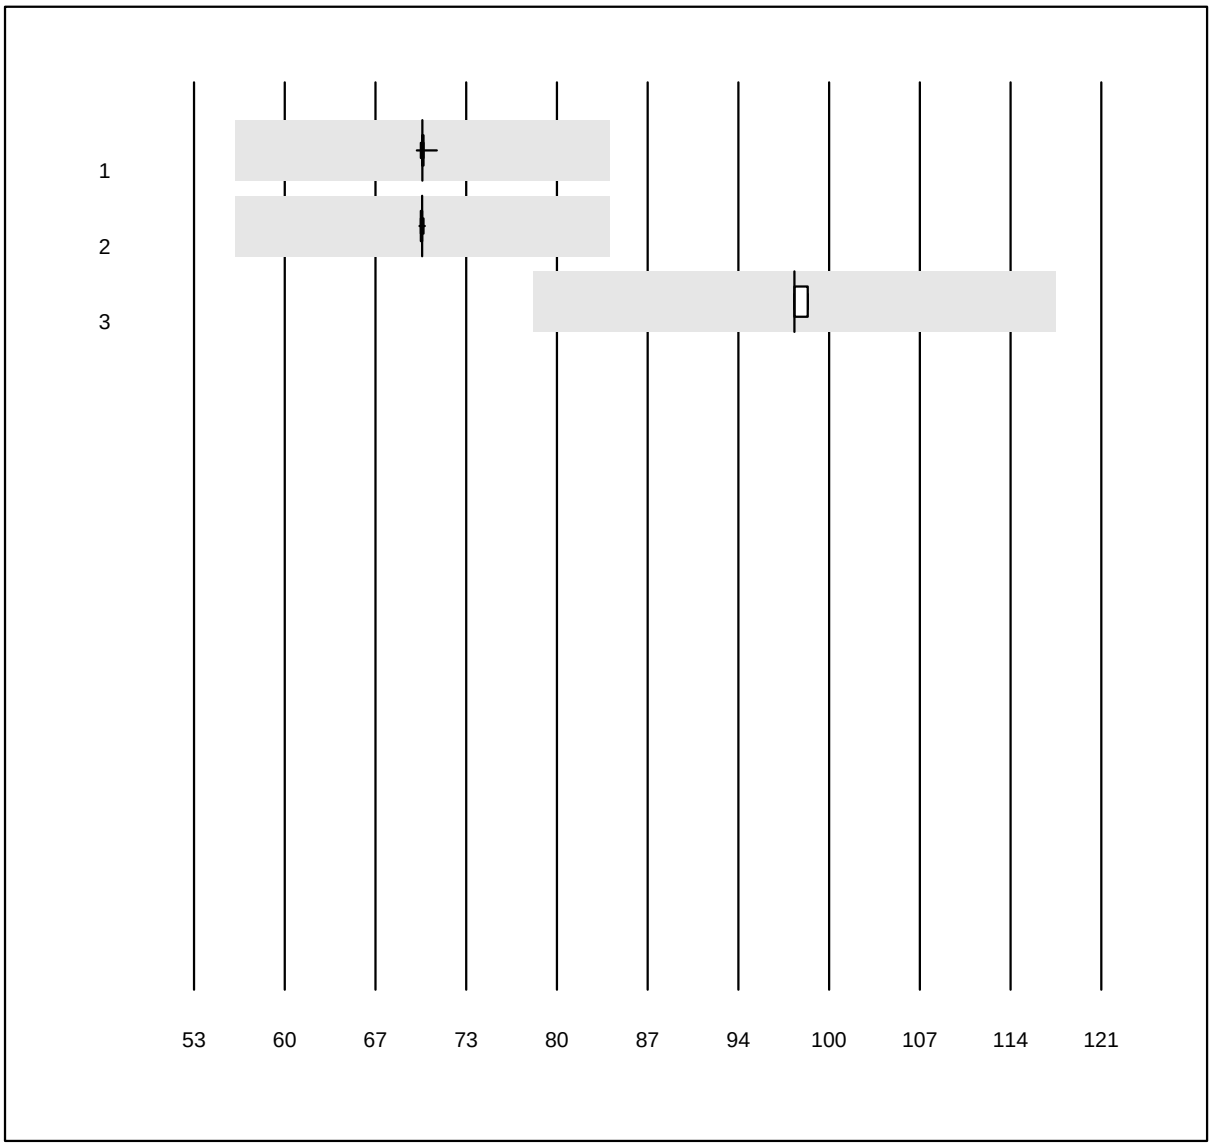


MQ Toleranz: 20%

sO2 OR (%)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	ABL700/800	104	99.0	0.0	1.0	70.114	0.2	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	148	100.0	0.0	0.0	70.100	0.1	e
3	iStat	33	100.0	0.0	0.0	98.000	0.5	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Sodium BG

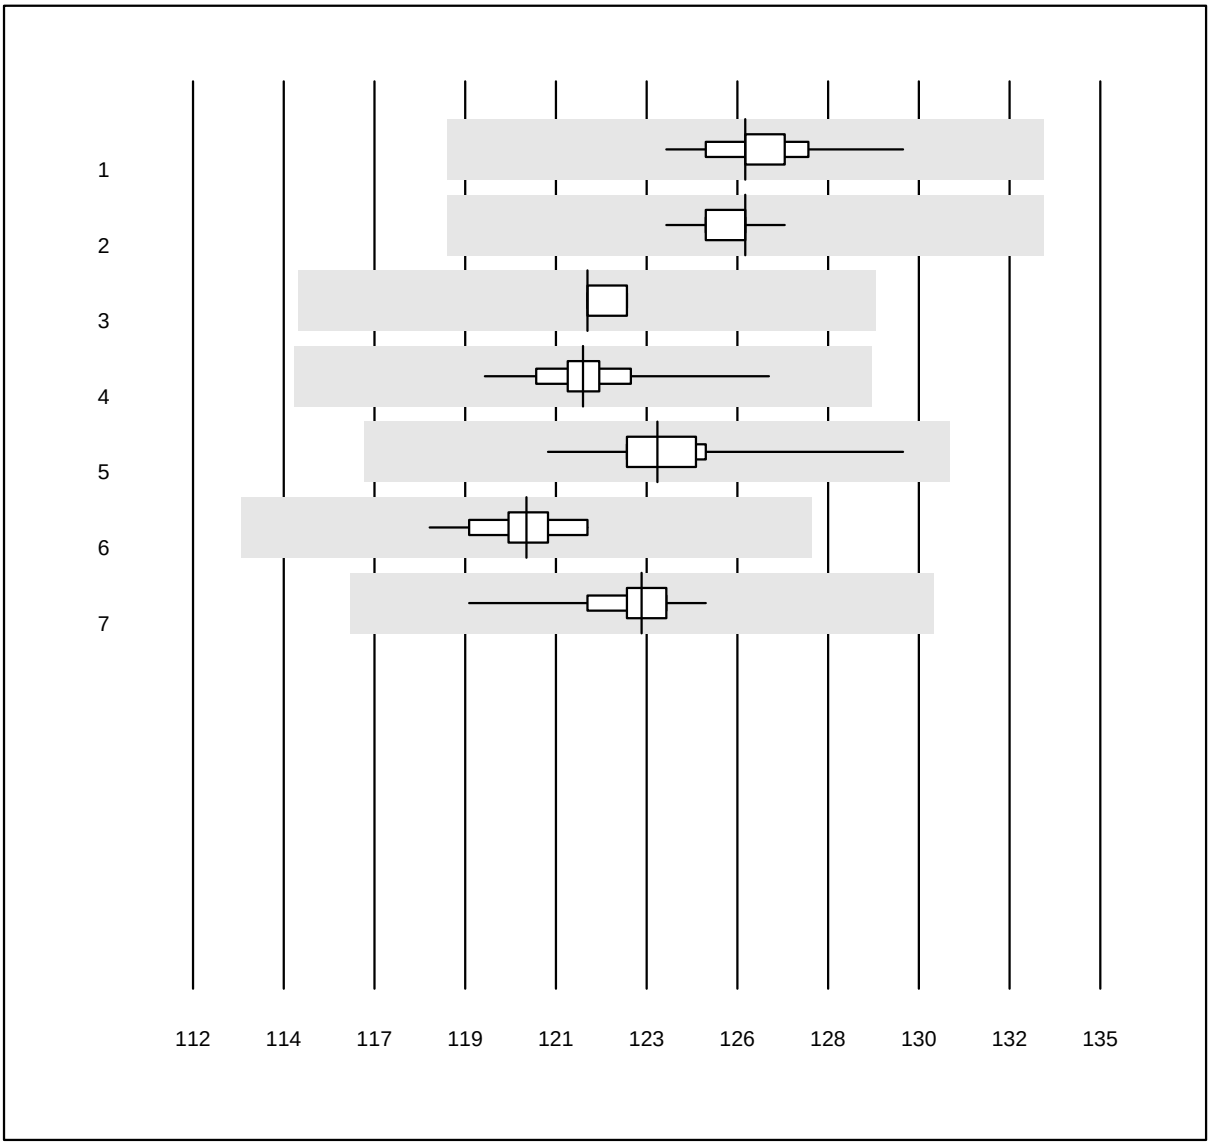


QUALAB Toleranz: 6%

Sodium BG (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	ABL700/800	113	100.0	0.0	0.0	126.0	0.7	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	161	100.0	0.0	0.0	126.0	0.4	e
3	GEM	14	100.0	0.0	0.0	122.0	0.4	e
4	Cobas b 123	19	100.0	0.0	0.0	121.9	1.1	e
5	iStat	24	100.0	0.0	0.0	123.8	1.3	e
6	EPOC	48	100.0	0.0	0.0	120.5	0.8	e
7	RAPIDPoint 500	29	100.0	0.0	0.0	123.4	0.9	e

3 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Potassium BG

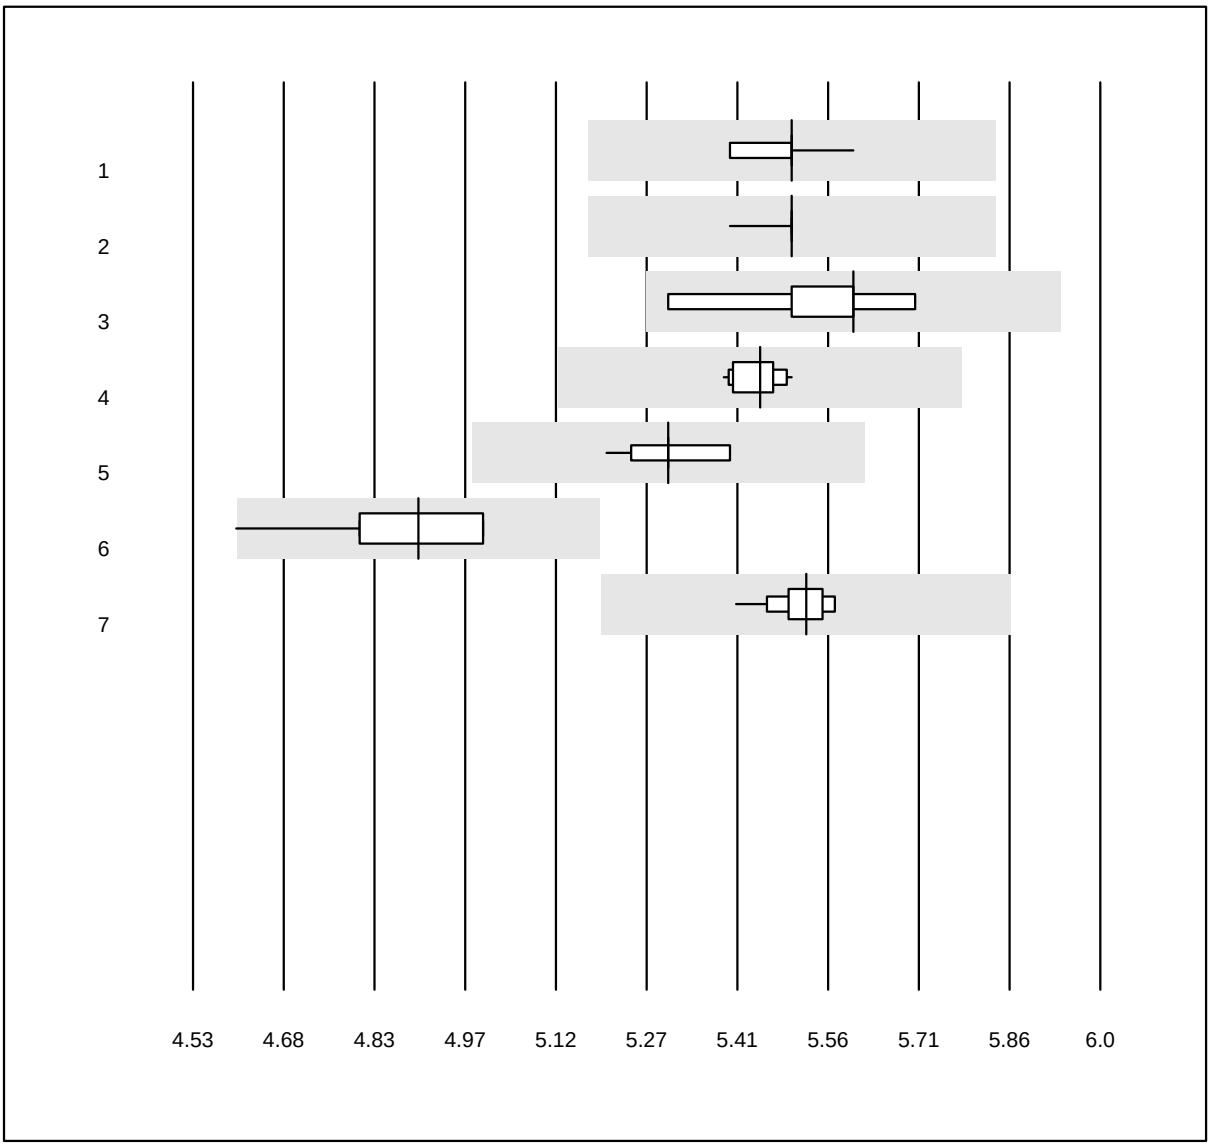


QUALAB Toleranz: 6%

Potassium BG (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	ABL700/800	114	100.0	0.0	0.0	5.5	1.0	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	162	100.0	0.0	0.0	5.5	0.5	e
3	GEM	13	100.0	0.0	0.0	5.6	2.3	e
4	Cobas b 123	18	94.4	0.0	5.6	5.4	0.6	e
5	iStat	24	95.8	0.0	4.2	5.3	0.9	e
6	EPOC	50	98.0	2.0	0.0	4.9	1.8	e
7	RAPIDPoint 500	29	100.0	0.0	0.0	5.5	0.7	e

3 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Chlorure-BG

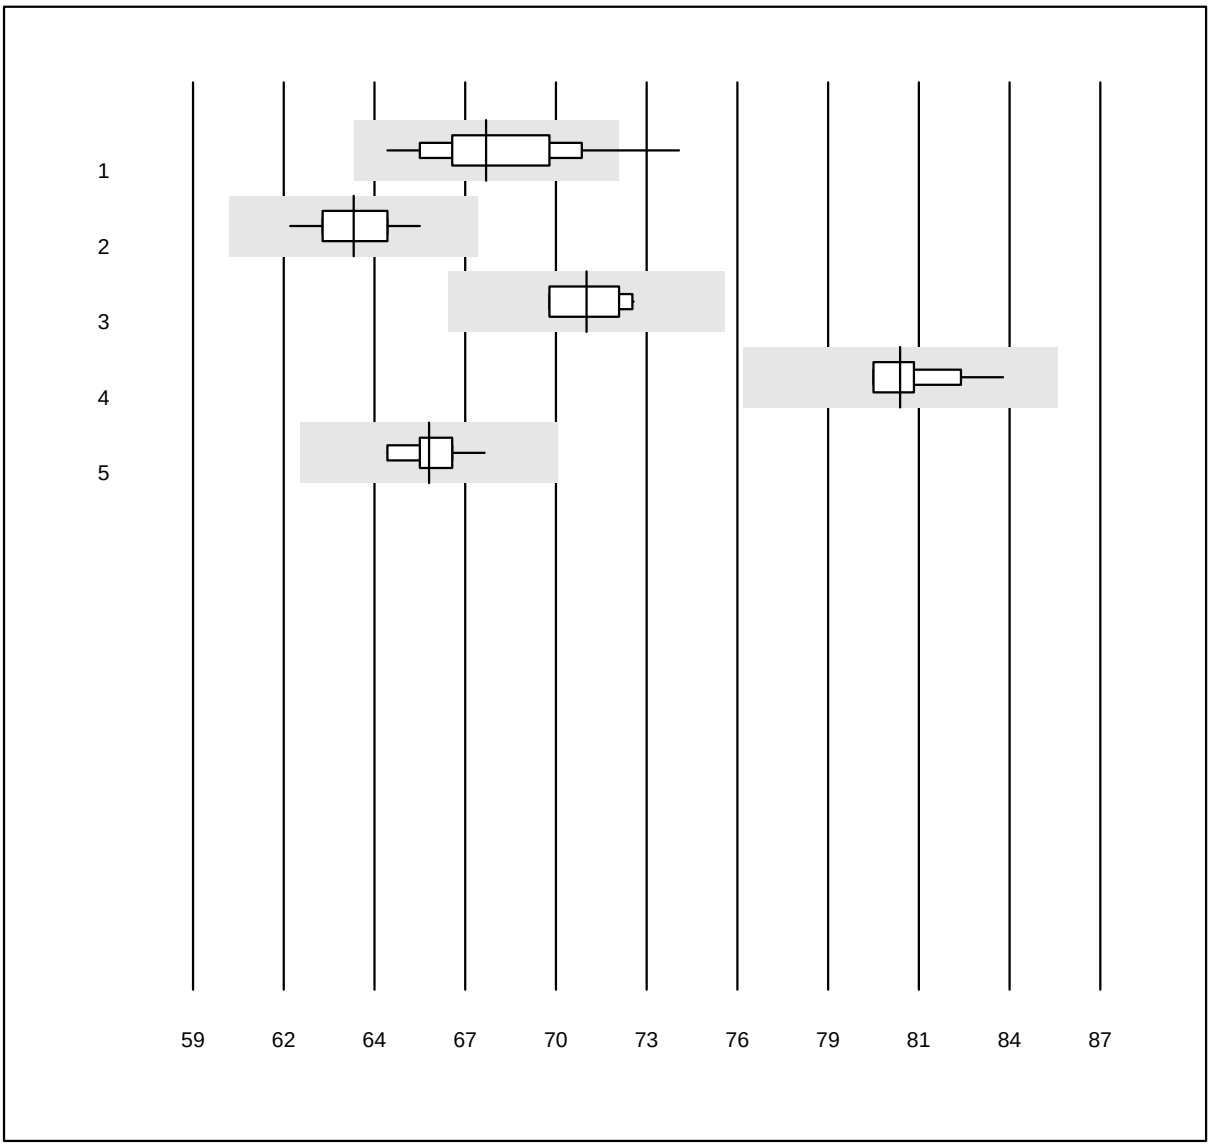


QUALAB Toleranz: 6%

Chlorure-BG (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	ABL700/800	111	95.5	3.6	0.9	68.0	3.1	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	155	100.0	0.0	0.0	64.0	1.4	e
3	Cobas b 123	13	100.0	0.0	0.0	71.1	1.4	e
4	EPOC	23	95.7	0.0	4.3	80.8	1.3	e
5	RAPIDPoint 500	29	100.0	0.0	0.0	66.3	1.3	e

4 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Calcium BG

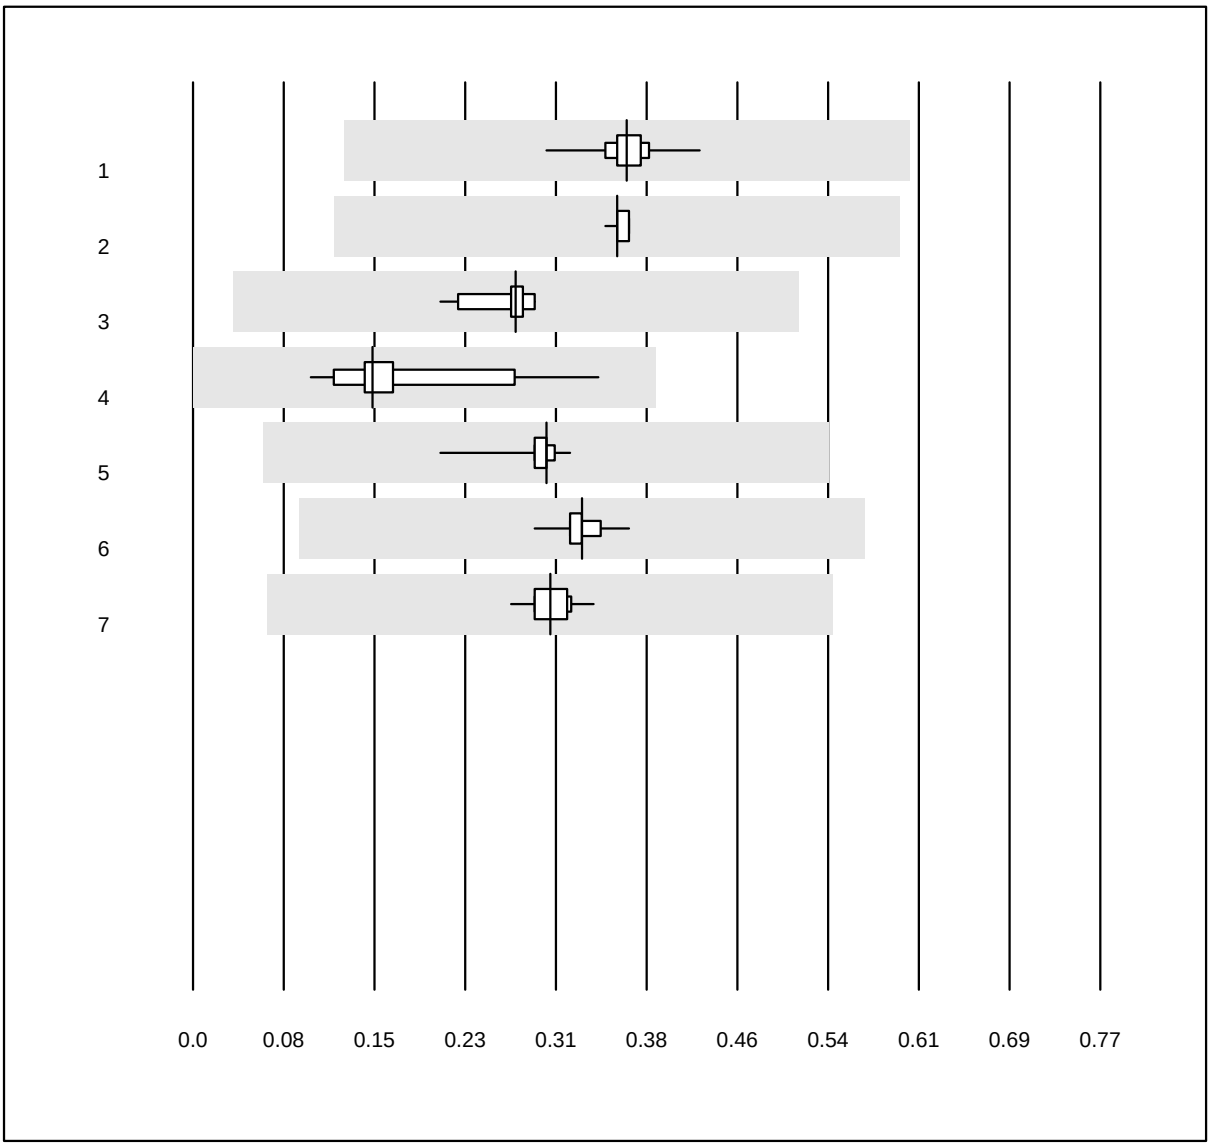


MQ Toleranz: 12%
(< 2.0: +/- 0.24 mmol/l)

Calcium BG (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	ABL700/800	113	99.1	0.0	0.9	0.37	4.7	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	159	100.0	0.0	0.0	0.36	1.6	e
3	GEM	12	100.0	0.0	0.0	0.27	7.7	e
4	Cobas b 123	14	100.0	0.0	0.0	0.15	34.1	e
5	iStat	22	100.0	0.0	0.0	0.30	6.8	e
6	EPOC	45	95.6	0.0	4.4	0.33	4.3	e
7	RAPIDPoint 500	28	100.0	0.0	0.0	0.30	5.0	e

4 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Glucose GS

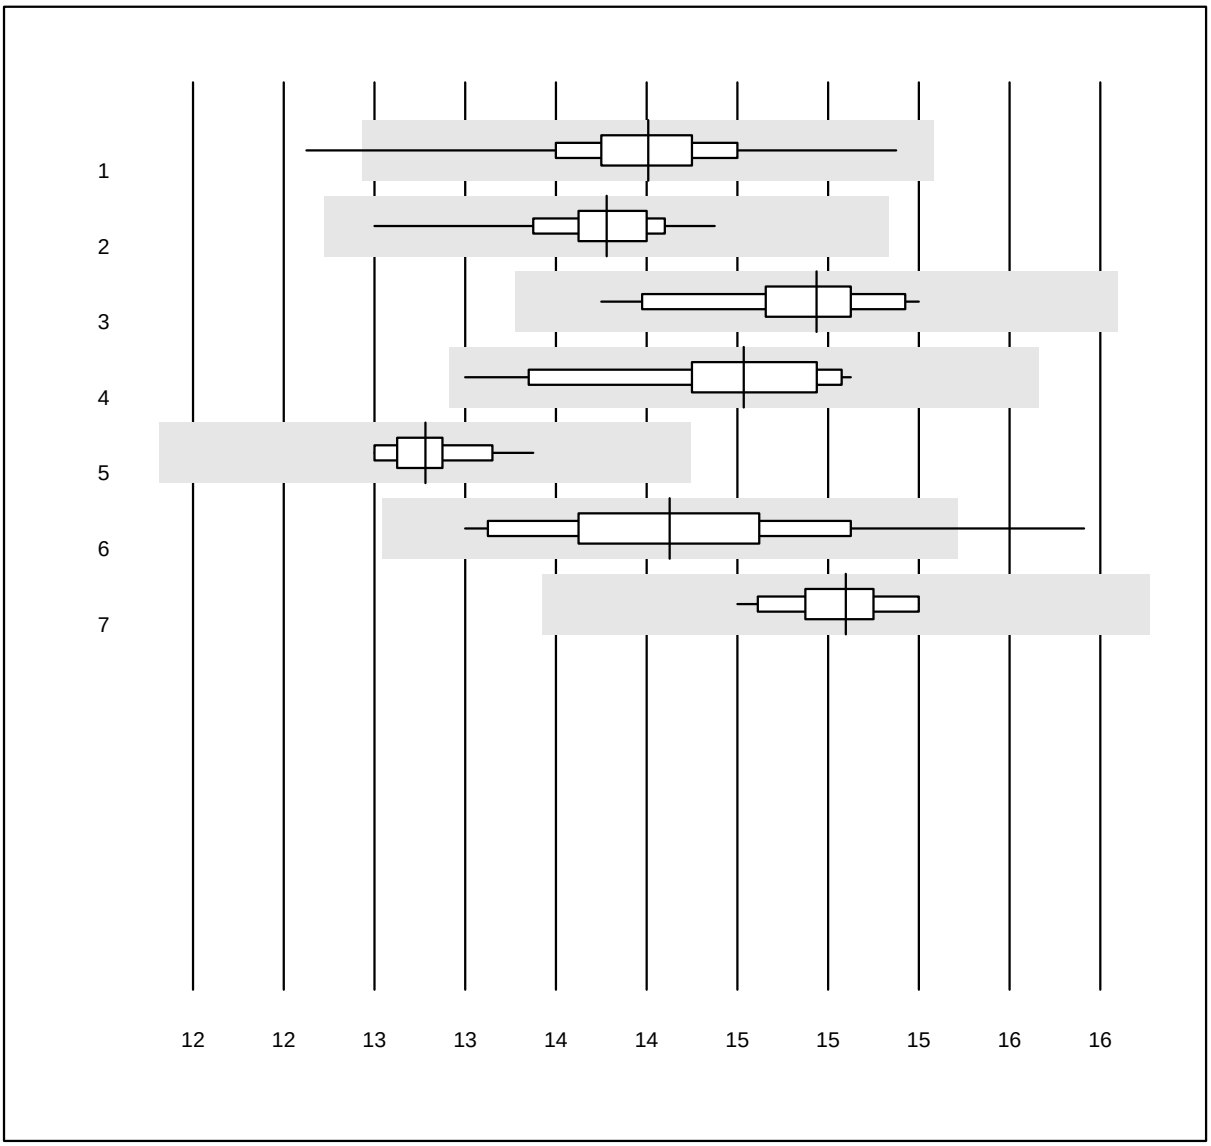


QUALAB Toleranz: 9%

Glucose GS (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	ABL700/800	114	99.1	0.9	0.0	14.0	2.7	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	151	100.0	0.0	0.0	13.8	1.8	e
3	GEM	12	100.0	0.0	0.0	14.7	2.5	e
4	Cobas b 123	13	100.0	0.0	0.0	14.4	3.2	e
5	iStat	15	100.0	0.0	0.0	13.0	1.4	e
6	EPOC	48	95.8	4.2	0.0	14.1	4.2	e
7	RAPIDPoint 500	28	100.0	0.0	0.0	14.9	1.6	e

4 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Lactate-BG

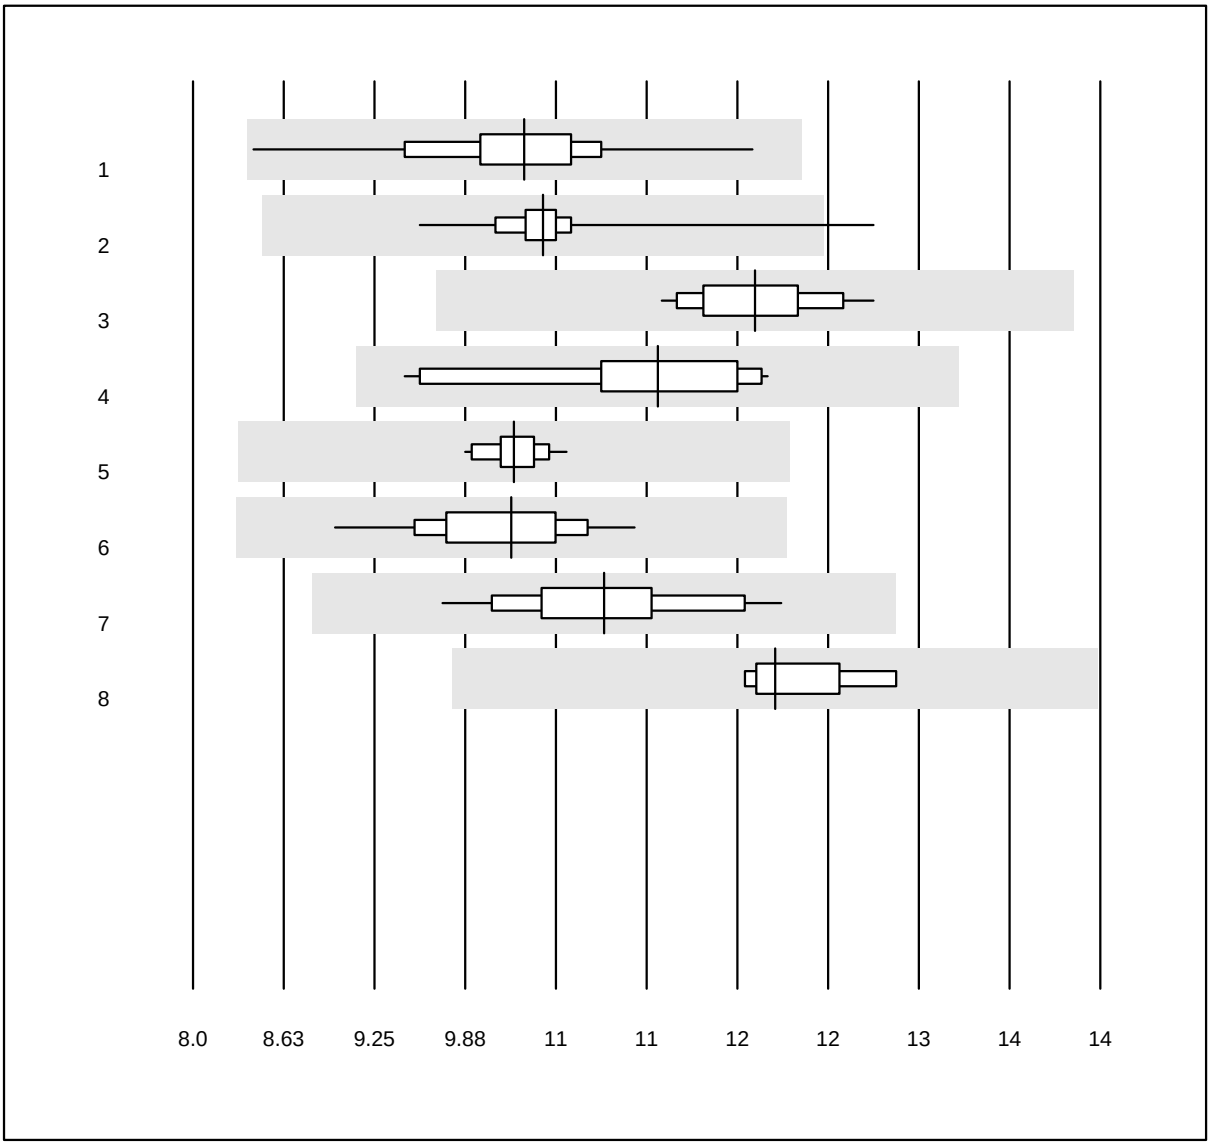


QUALAB Toleranz: 18%

Lactate-BG (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	ABL700/800	119	100.0	0.0	0.0	10.19	5.2	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	164	99.4	0.6	0.0	10.31	2.8	e
3	GEM	14	100.0	0.0	0.0	11.72	3.2	e
4	Cobas b 123	11	100.0	0.0	0.0	11.07	7.0	e
5	iStat	20	100.0	0.0	0.0	10.12	1.8	e
6	EPOC	46	95.7	0.0	4.3	10.10	4.3	e
7	RAPIDPoint 500	30	100.0	0.0	0.0	10.72	5.3	e
8	IL	4	100.0	0.0	0.0	11.85	2.6	e

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Troponine T

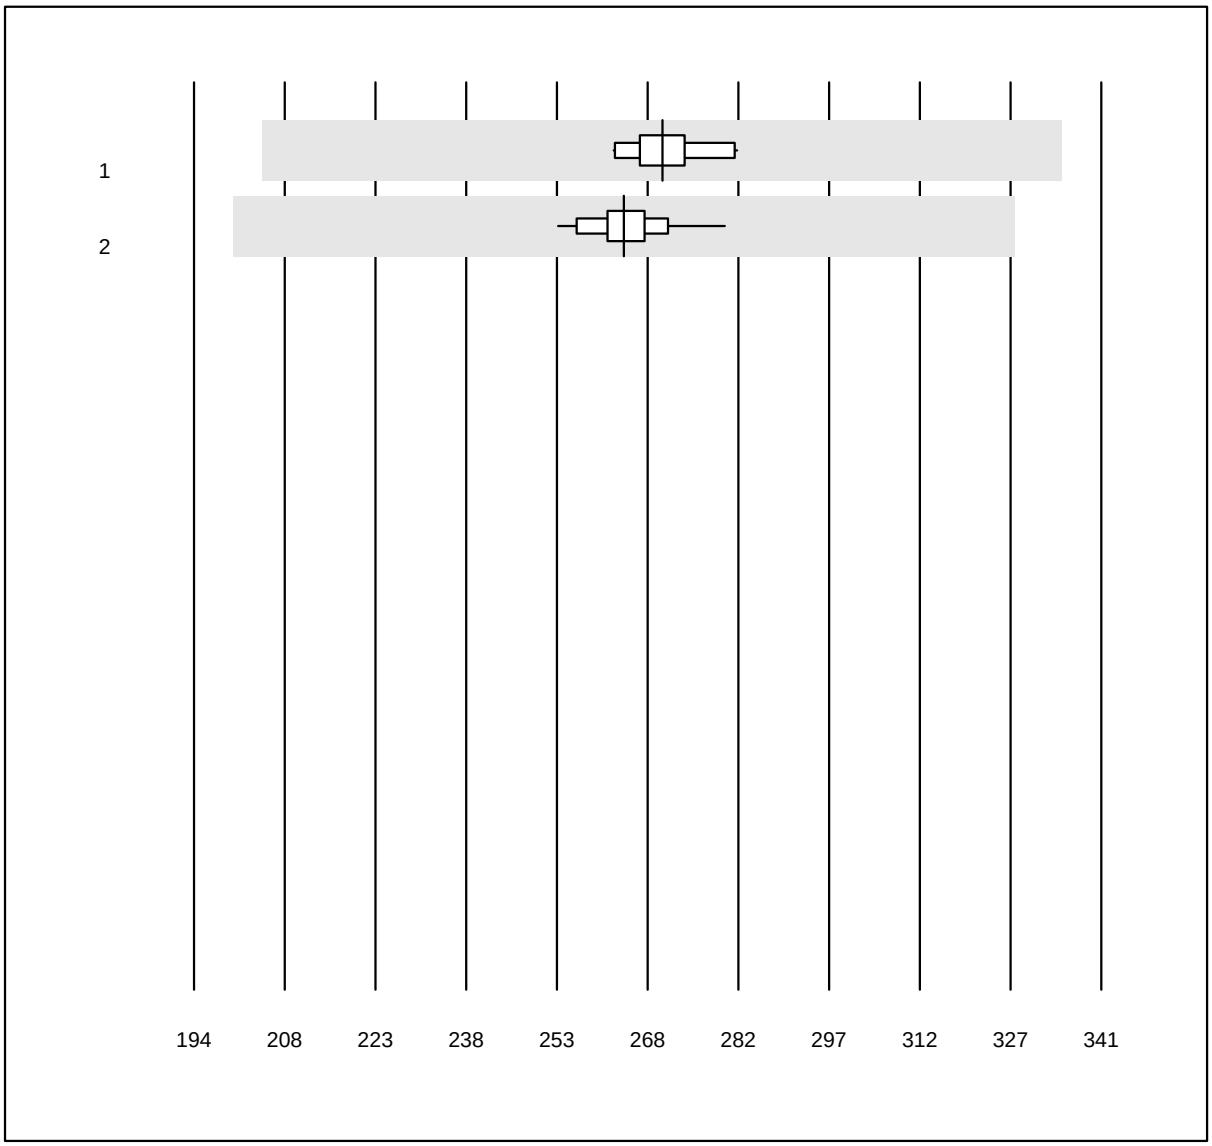


QUALAB Toleranz: 24%

Troponine T (ng/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Cobas hs	10	100.0	0.0	0.0	269.91	2.2	e
2	Cobas hs STAT	25	100.0	0.0	0.0	263.65	2.2	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Troponine I

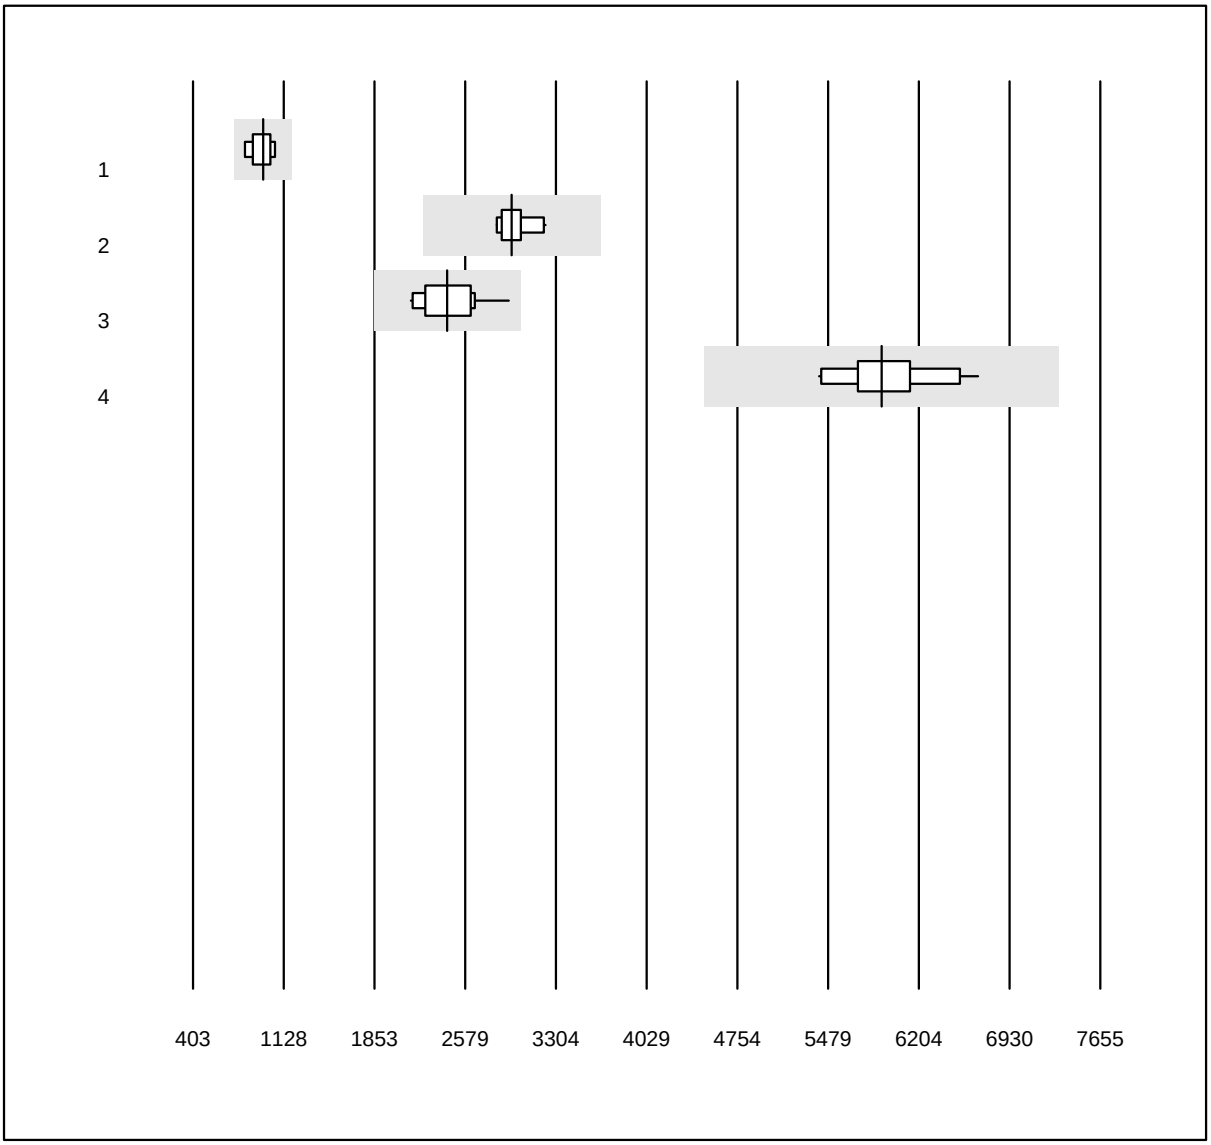


QUALAB Toleranz: 24%

Troponine I (ng/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	4	100.0	0.0	0.0	964.2	7.7	e*
2	Siemens	10	100.0	0.0	0.0	2949.9	4.0	e
3	Pathfast	20	100.0	0.0	0.0	2434.7	8.5	e
4	Vidas	14	100.0	0.0	0.0	5907.4	6.0	e

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

NT-proBNP

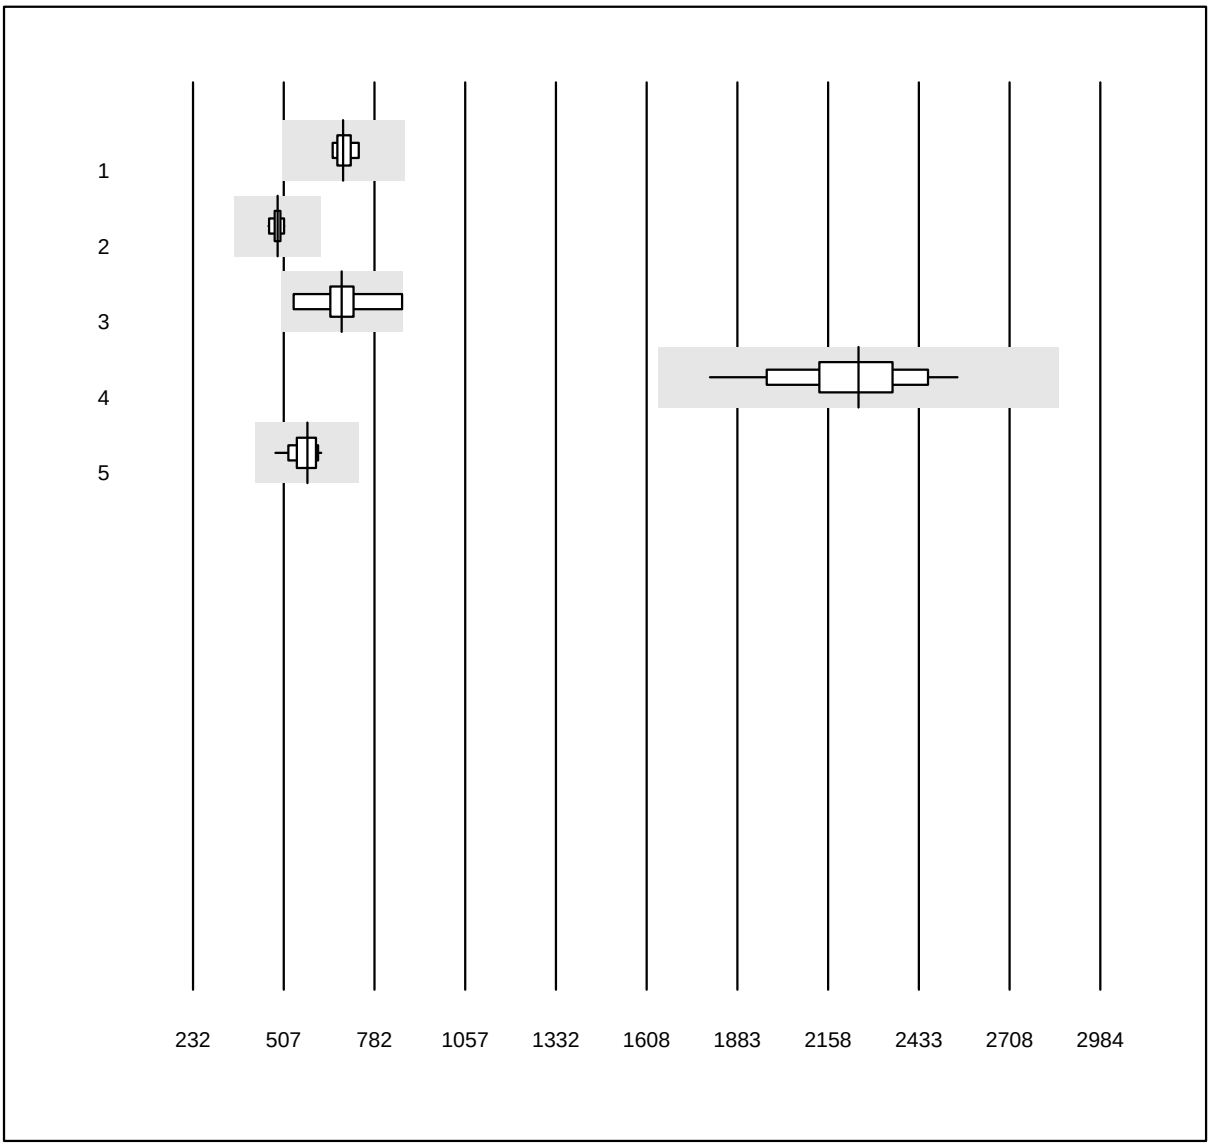


QUALAB Toleranz: 27%

NT-proBNP (ng/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	5	100.0	0.0	0.0	687.4	3.4	e
2	Siemens	10	100.0	0.0	0.0	488.8	2.7	e
3	VIDAS	9	88.9	0.0	11.1	683.0	12.4	e*
4	Pathfast	16	100.0	0.0	0.0	2250.8	7.9	e
5	Cobas E / Elecsys	31	100.0	0.0	0.0	579.0	6.1	e

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Créatine-Kinase (CK-MB), masse

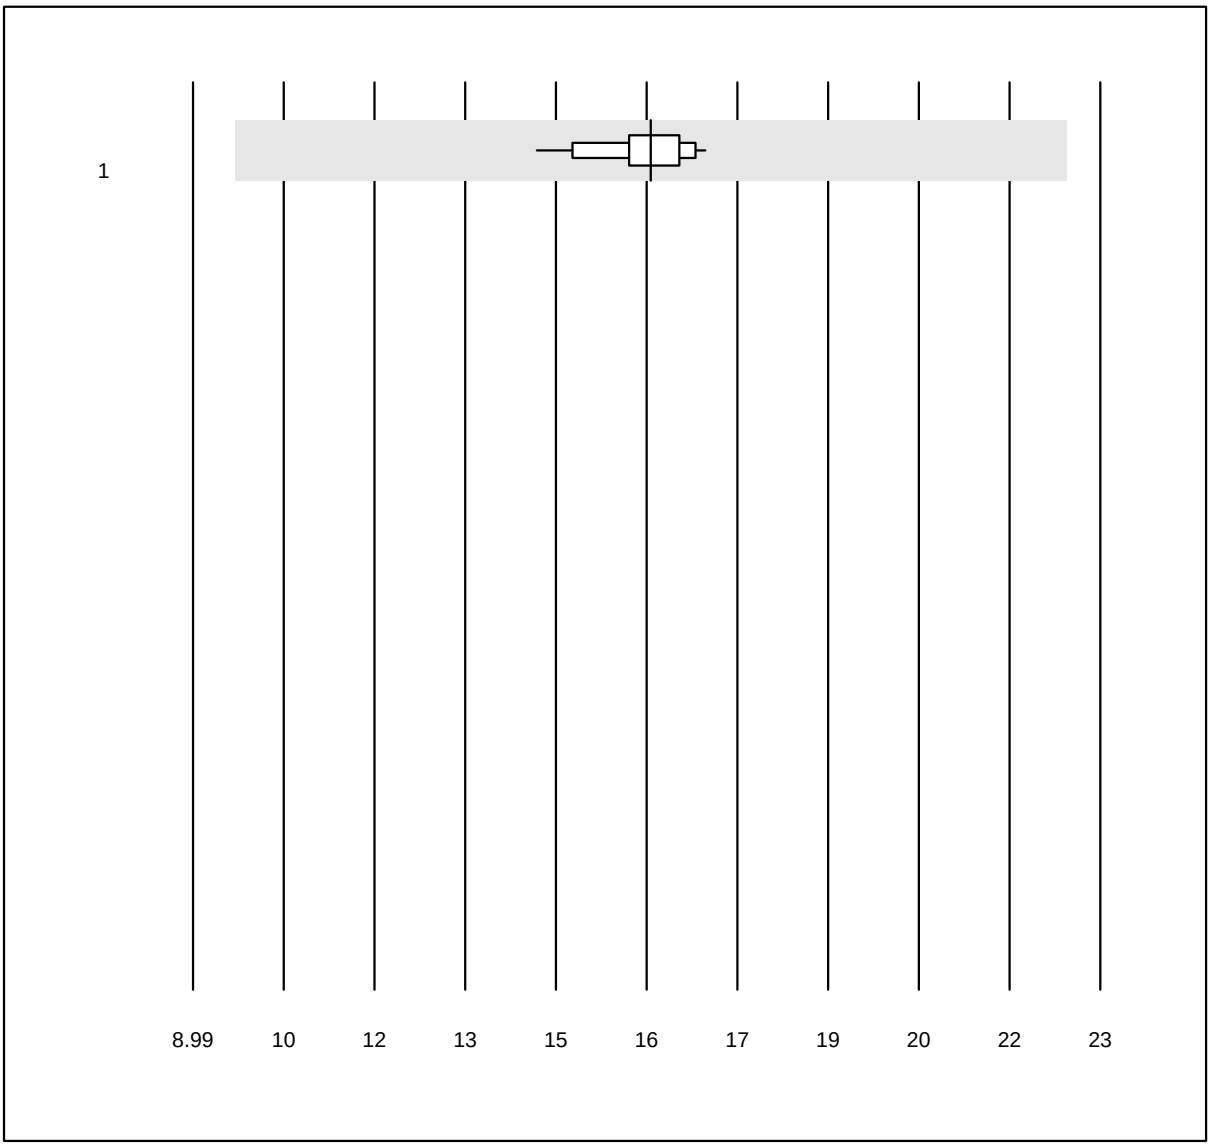


MQ Toleranz: 40%

Créatine-Kinase (CK-MB), masse (µg/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Cobas E / Elecsys	14	100.0	0.0	0.0	16.1	4.0	e

3 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Myoglobine

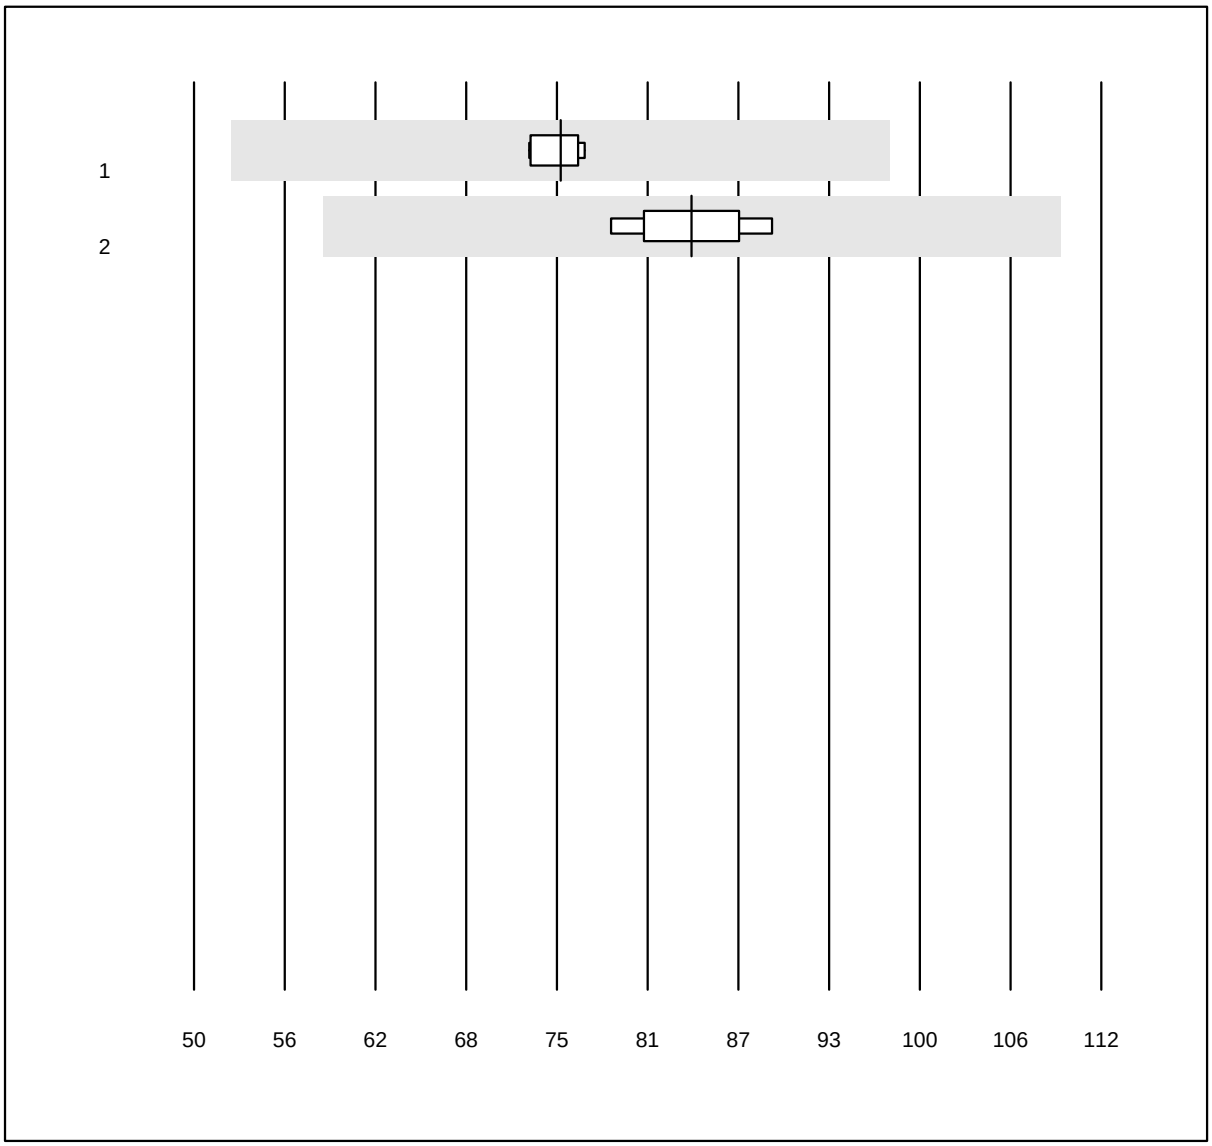


QUALAB Toleranz: 30%

Myoglobine (µg/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Cobas E / Elecsys	10	100.0	0.0	0.0	75.1	2.1	e
2	Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	84.0	4.0	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

17-OH-Progesteron

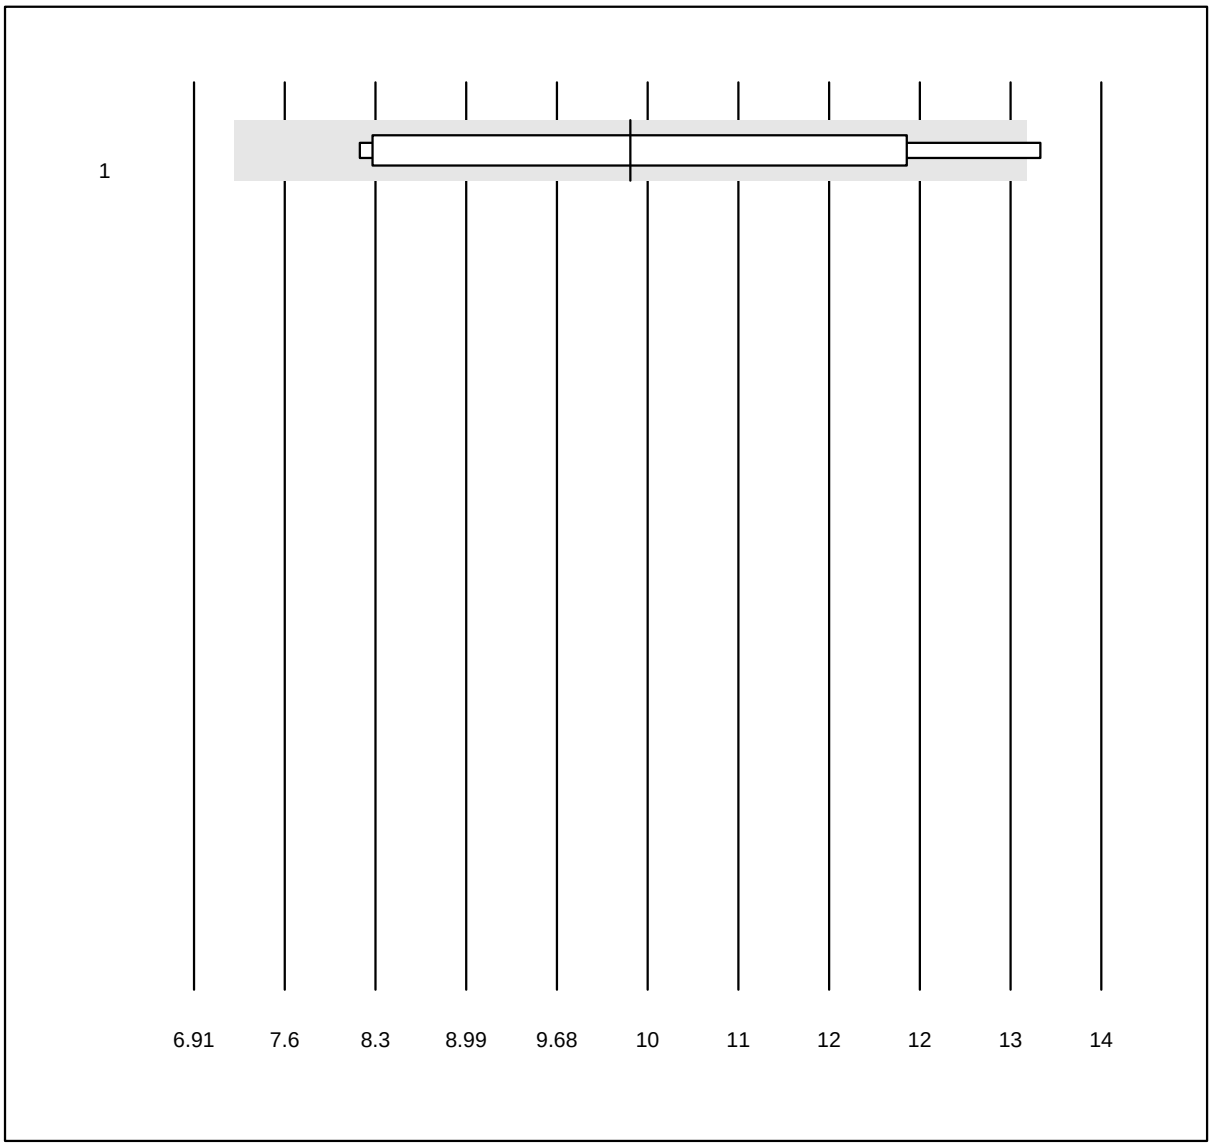


MQ Toleranz: 30%

17-OH-Progesteron (nmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Autres méthodes	5	100.0	0.0	0.0	10.3	20.4	e*

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Androstendion

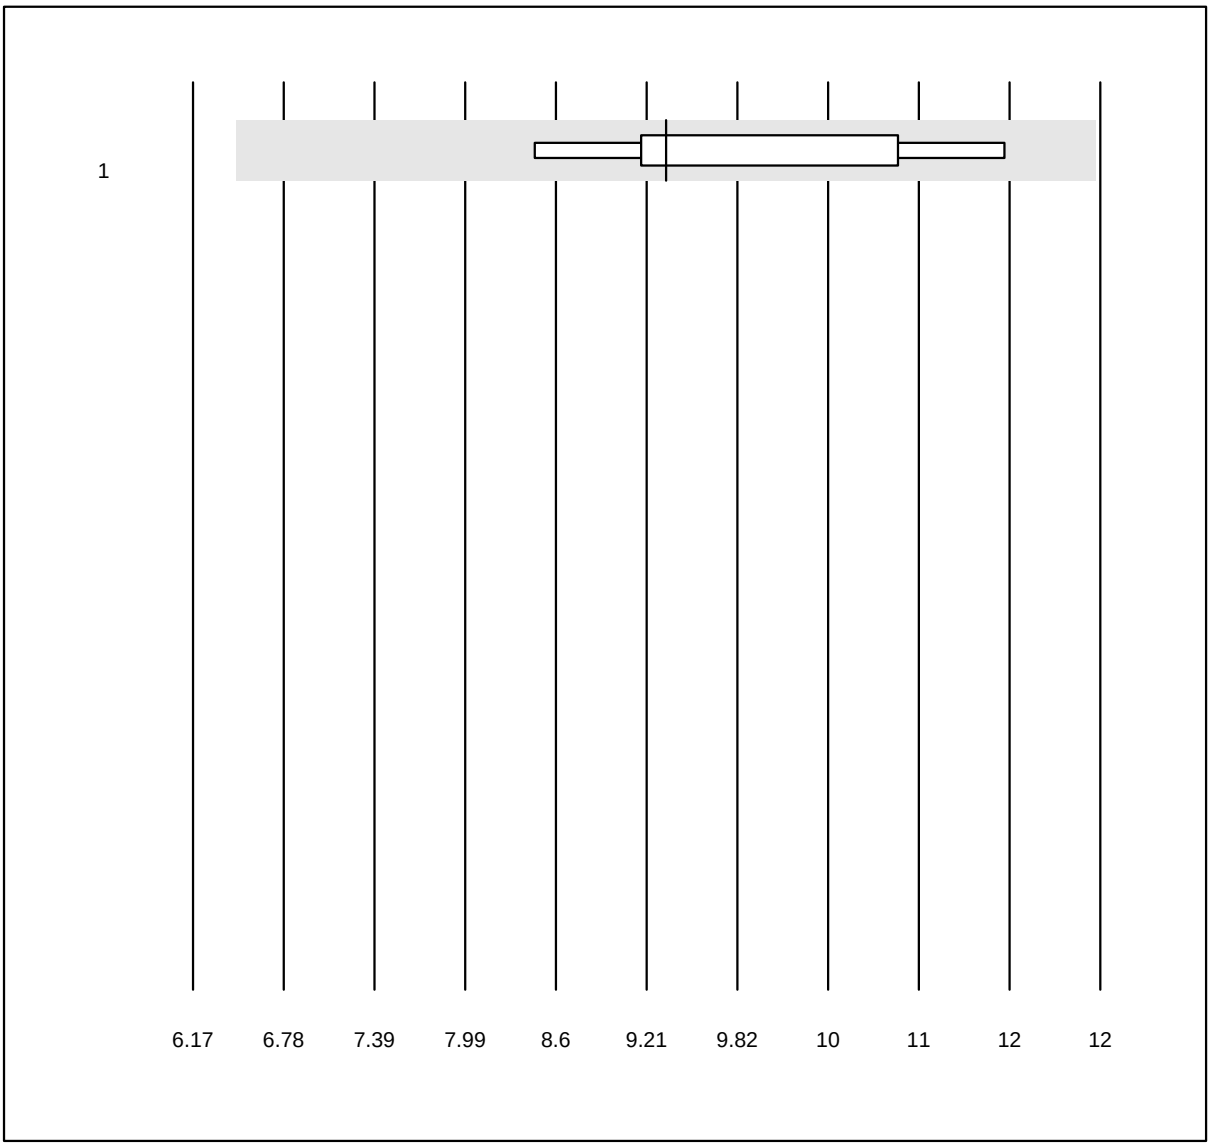


MQ Toleranz: 30%

Androstendion (nmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	7	100.0	0.0	0.0	9.2	10.5	e*

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Beta-HCG total

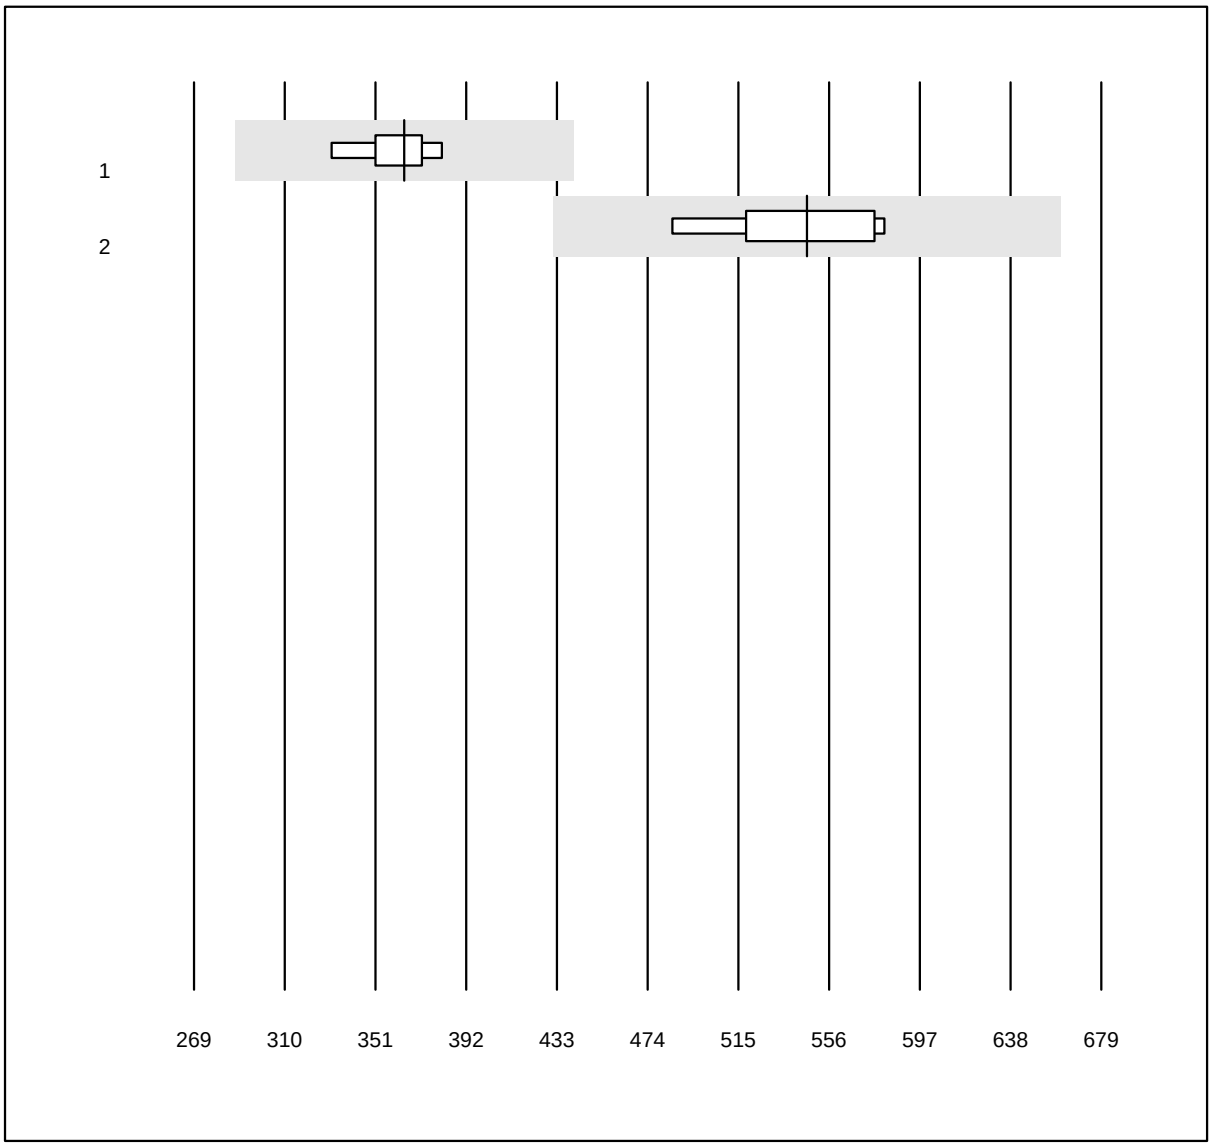


QUALAB Toleranz: 21%

Beta-HCG total (U/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	5	100.0	0.0	0.0	364.0	3.7	e
2	AFIAS	6	83.3	0.0	16.7	546.0	5.8	e

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Cortisol

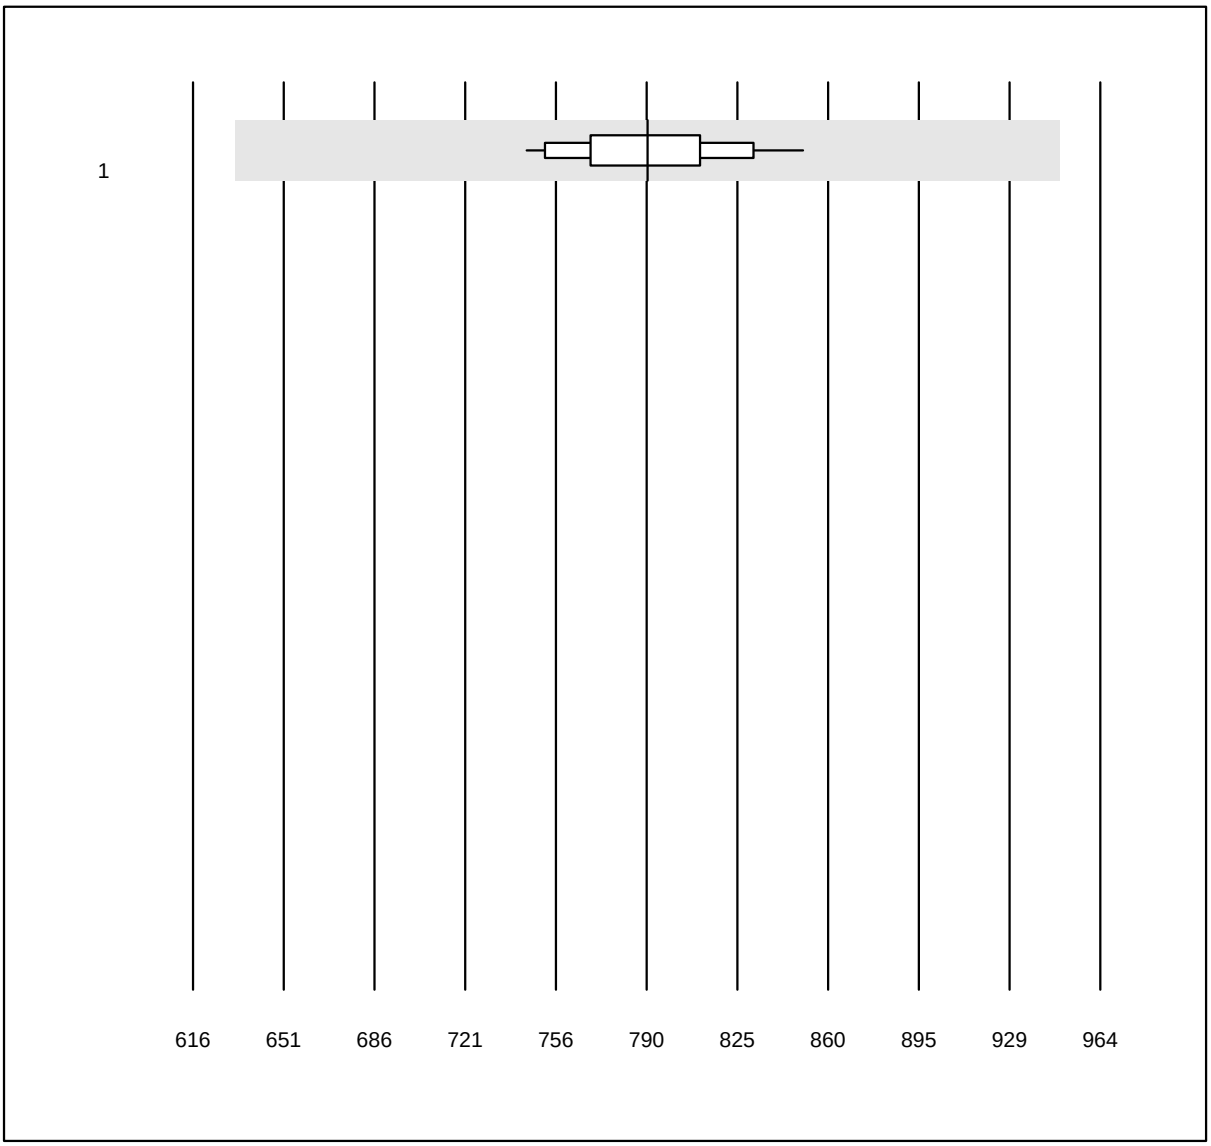


QUALAB Toleranz: 20%

Cortisol (nmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	26	100.0	0.0	0.0	790	3.6	e

4 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

DHEAS

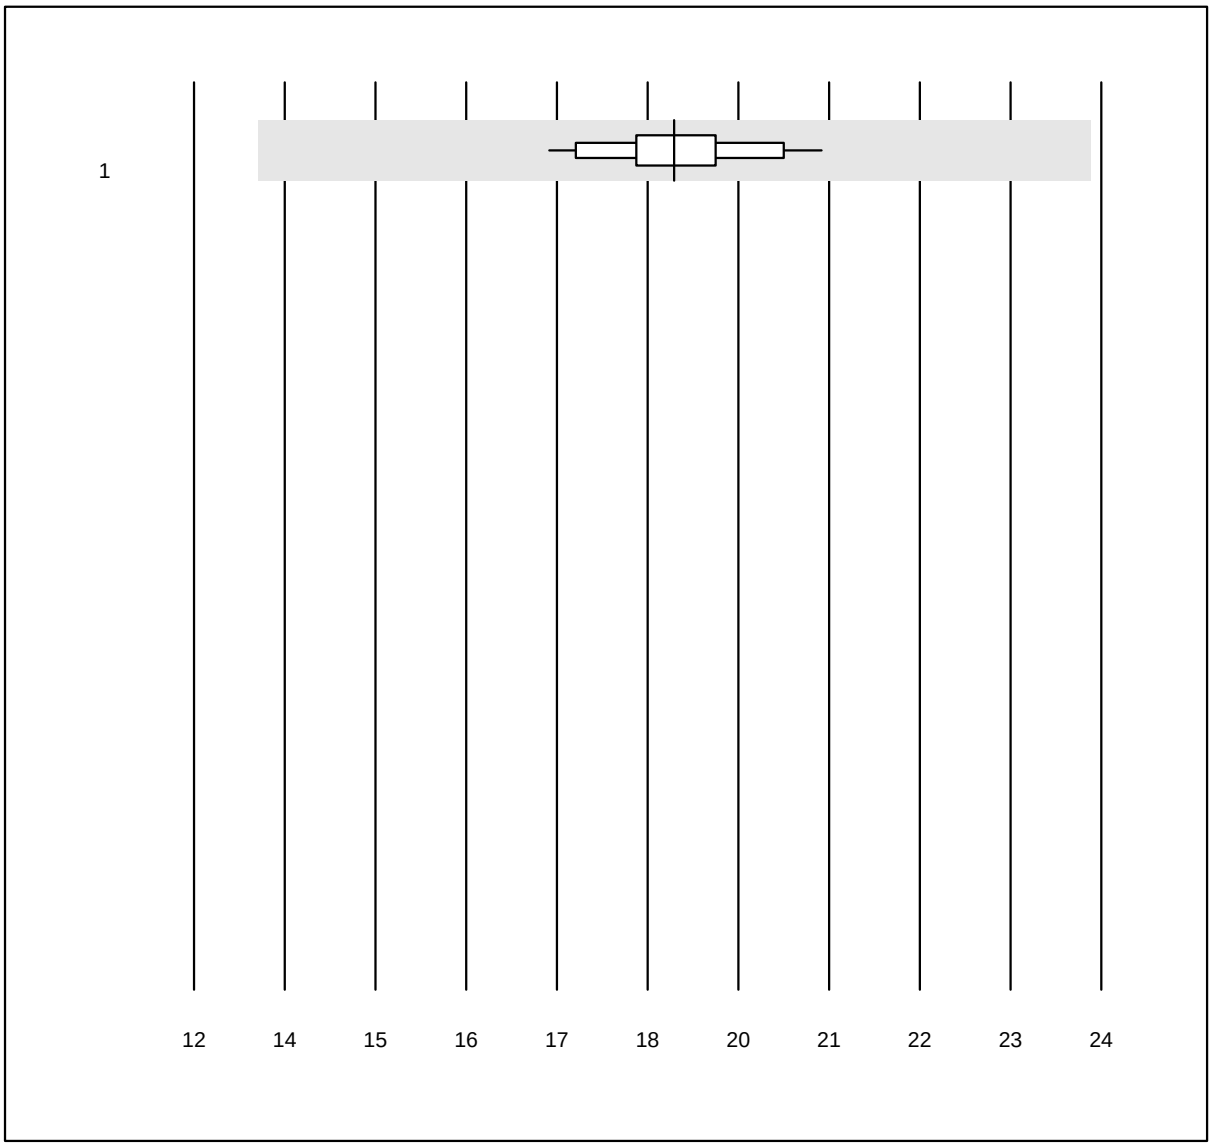


MQ Toleranz: 30%

DHEAS (µmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	14	100.0	0.0	0.0	18.35	4.9	e

4 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Estradiol

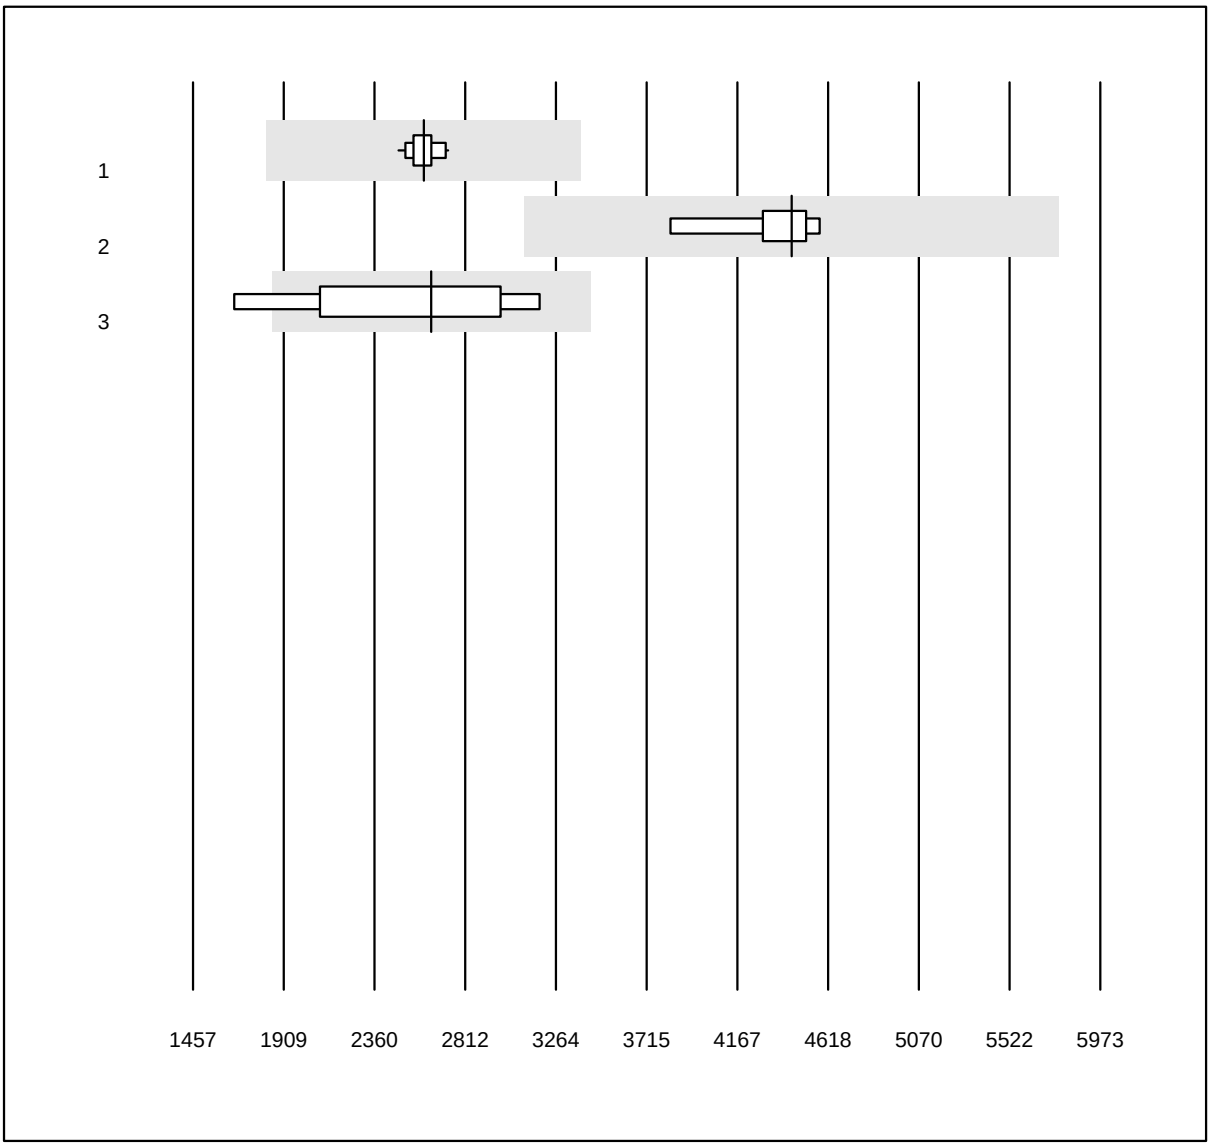


QUALAB Toleranz: 30%

Estradiol (pmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	17	100.0	0.0	0.0	2606	2.5	e
2	Siemens	8	100.0	0.0	0.0	4437	5.1	e
3	Autres méthodes	5	100.0	0.0	0.0	2642	19.1	e*

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Hormone folliculo-stimulante

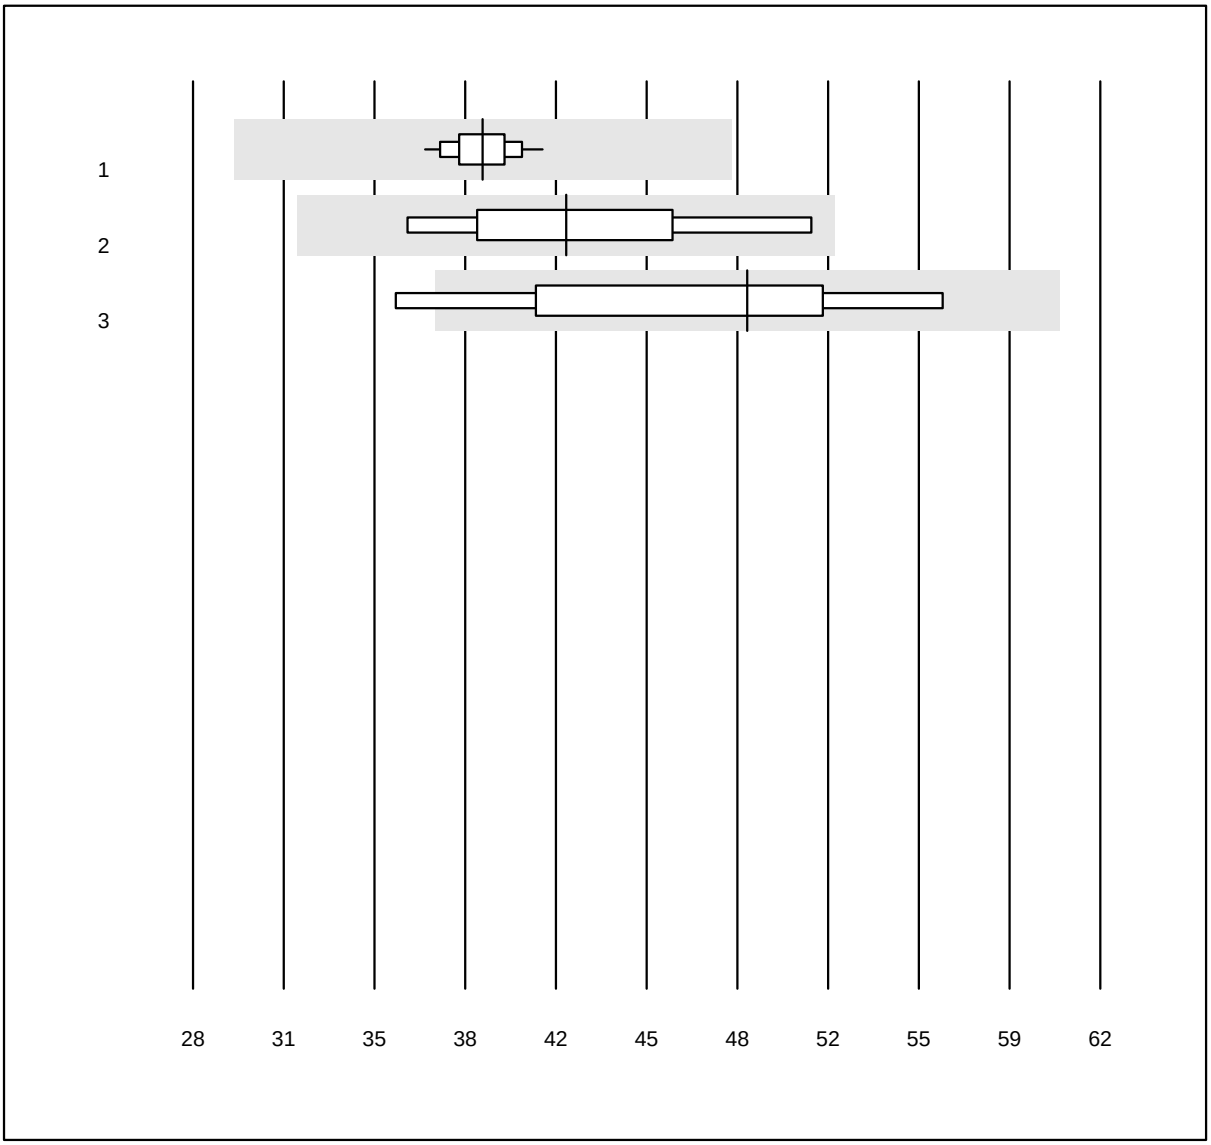


QUALAB Toleranz: 24%

Hormone folliculo-stimulante (U/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	16	100.0	0.0	0.0	38.9	2.9	e
2	ADVIA Centaur XP/CP	5	100.0	0.0	0.0	42.0	10.2	e*
3	Autres méthodes	5	80.0	0.0	20.0	48.8	12.4	e*

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

HGH

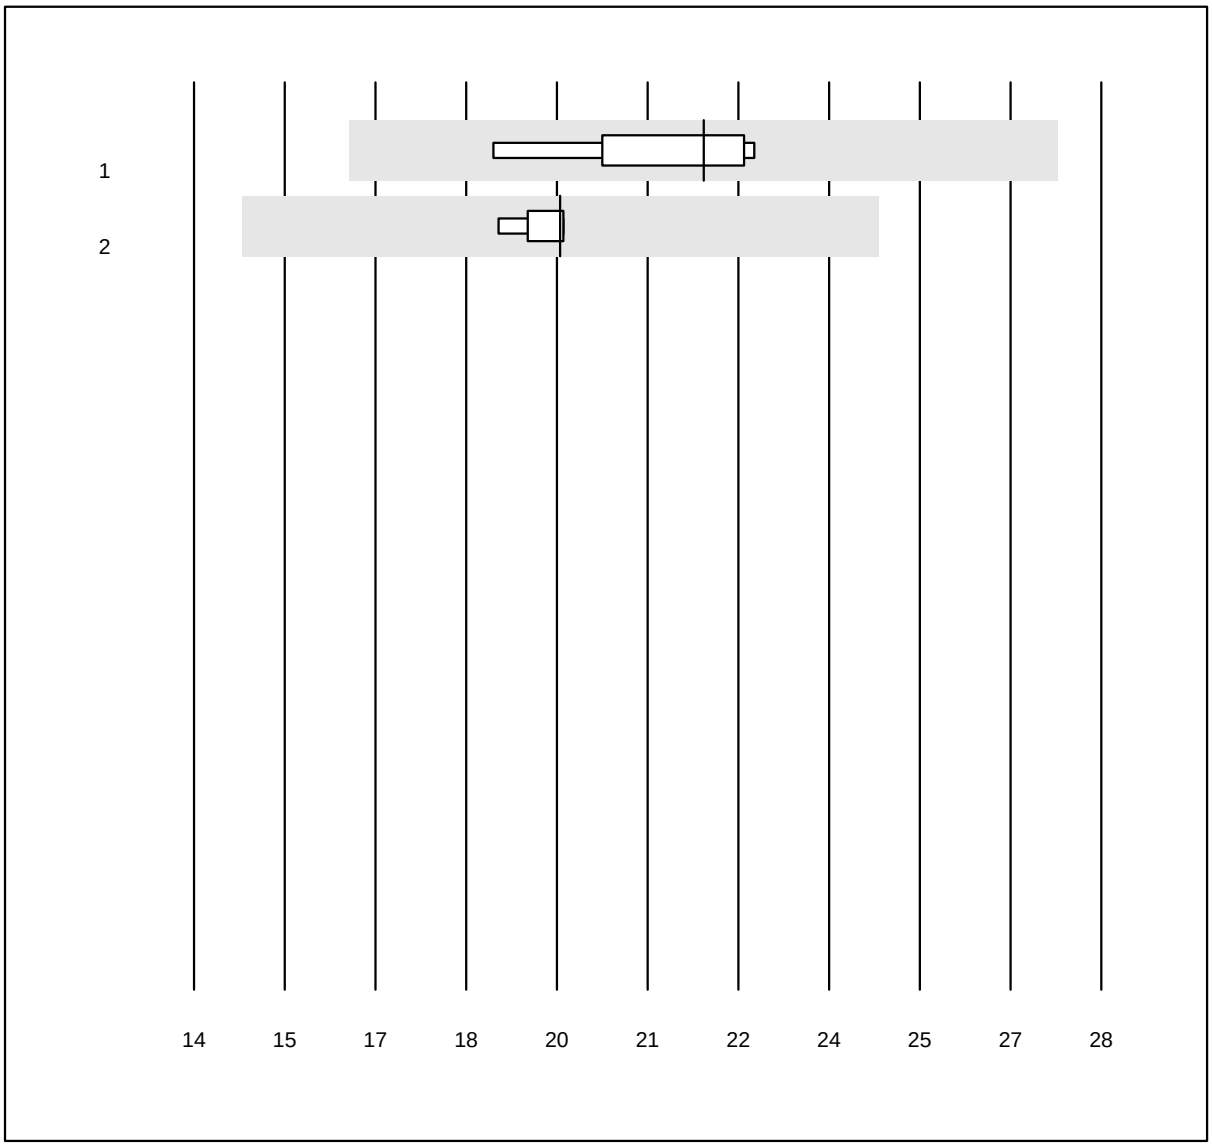


MQ Toleranz: 25%

HGH (µg/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Autres méthodes	7	85.7	0.0	14.3	21.87	6.1	e
2	Liaison	4	100.0	0.0	0.0	19.65	1.7	e

Insuline

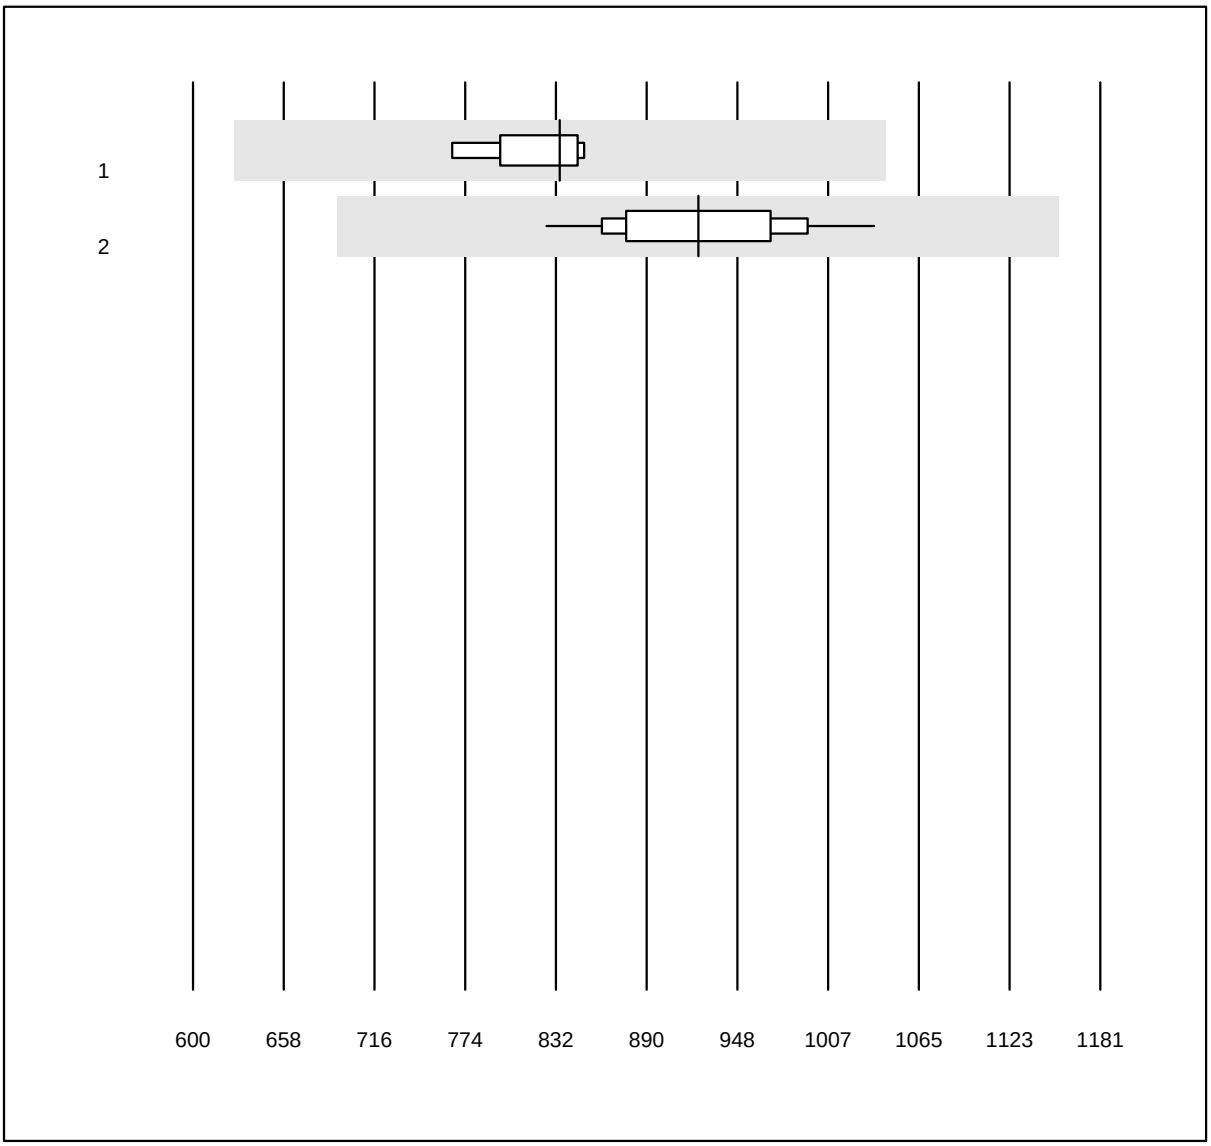


MQ Toleranz: 25%

Insuline (pmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	4	100.0	0.0	0.0	835	3.3	e
2	Roche	20	100.0	0.0	0.0	924	5.9	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Luteinisierendes Hormon

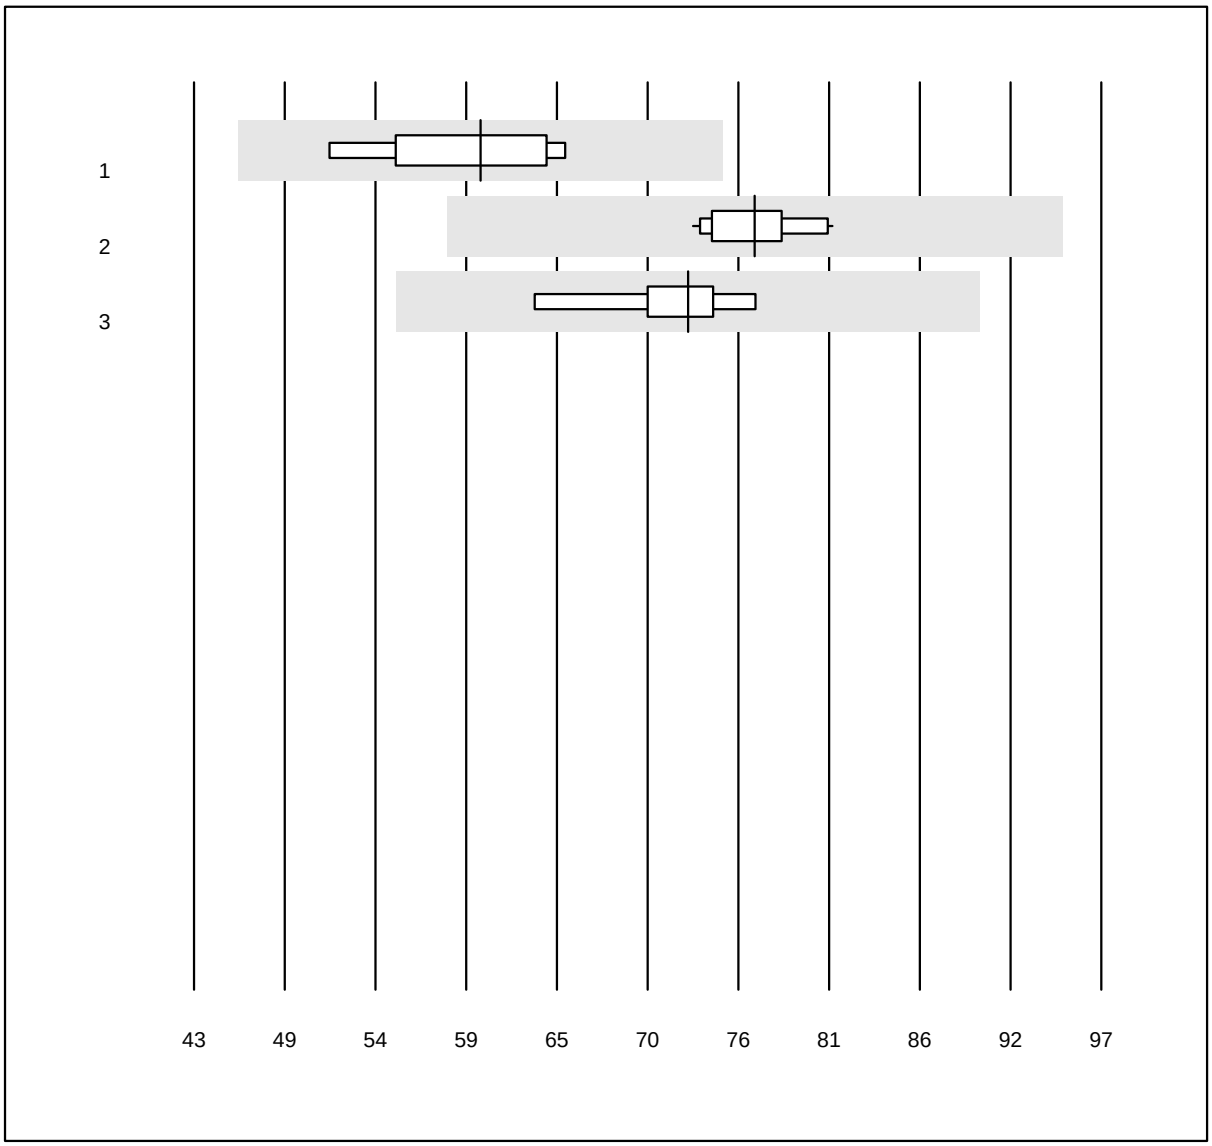


QUALAB Toleranz: 24%

Luteinisierendes Hormon
(U/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	5	100.0	0.0	0.0	60.1	8.0	e*
2	Roche	16	100.0	0.0	0.0	76.4	3.4	e
3	Siemens	7	100.0	0.0	0.0	72.4	5.1	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Progestérone

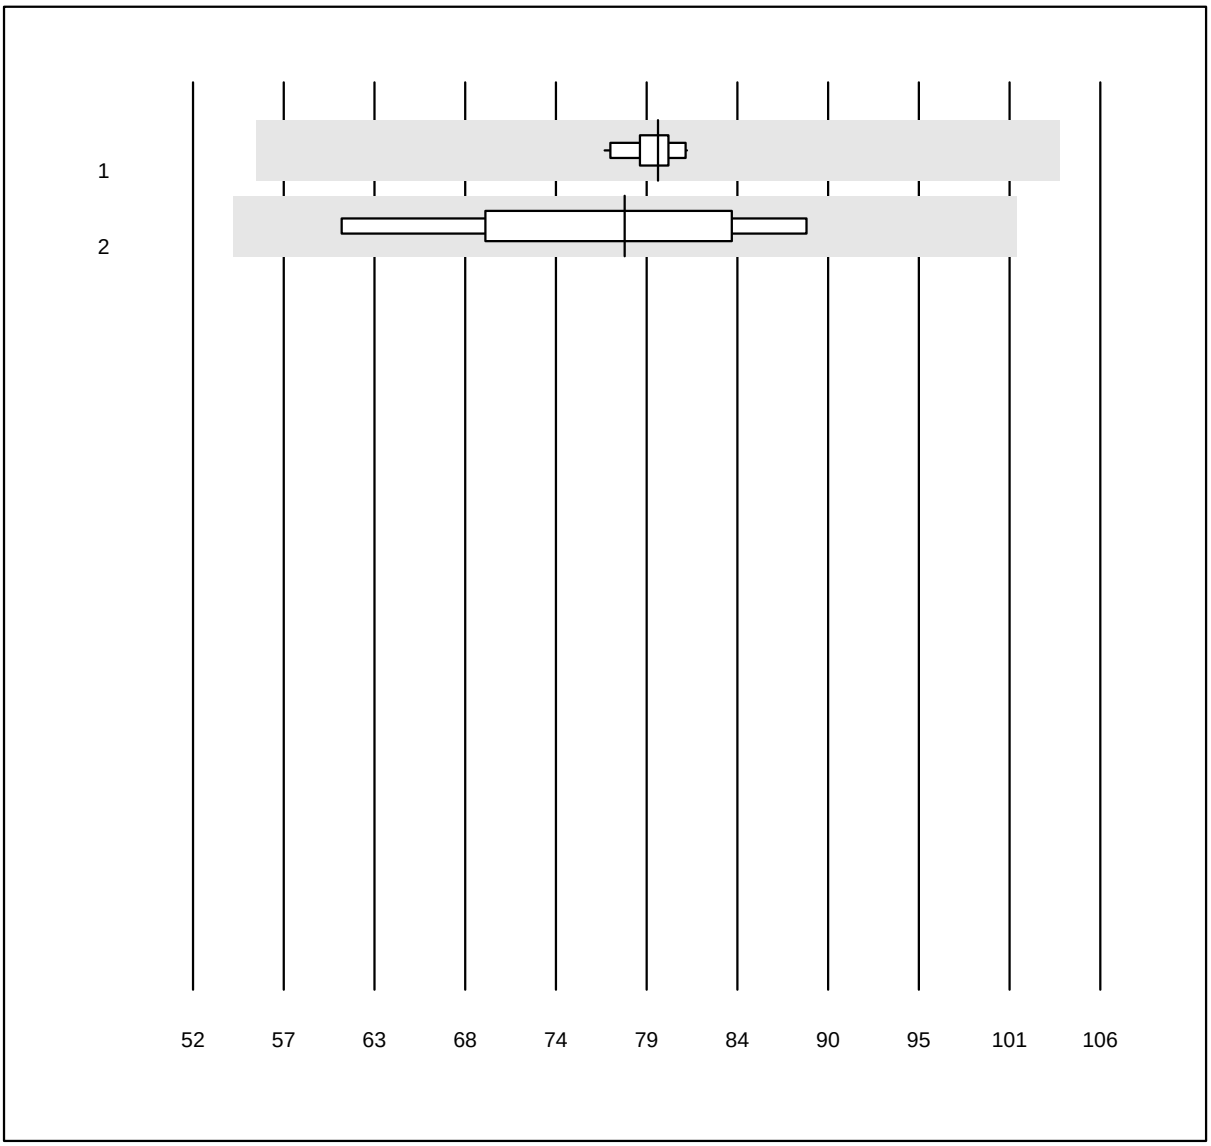


MQ Toleranz: 30%

Progestérone (nmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	11	100.0	0.0	0.0	79.7	1.7	e
2	Autres méthodes	5	100.0	0.0	0.0	77.7	10.7	e*

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Prolactine (PRL)

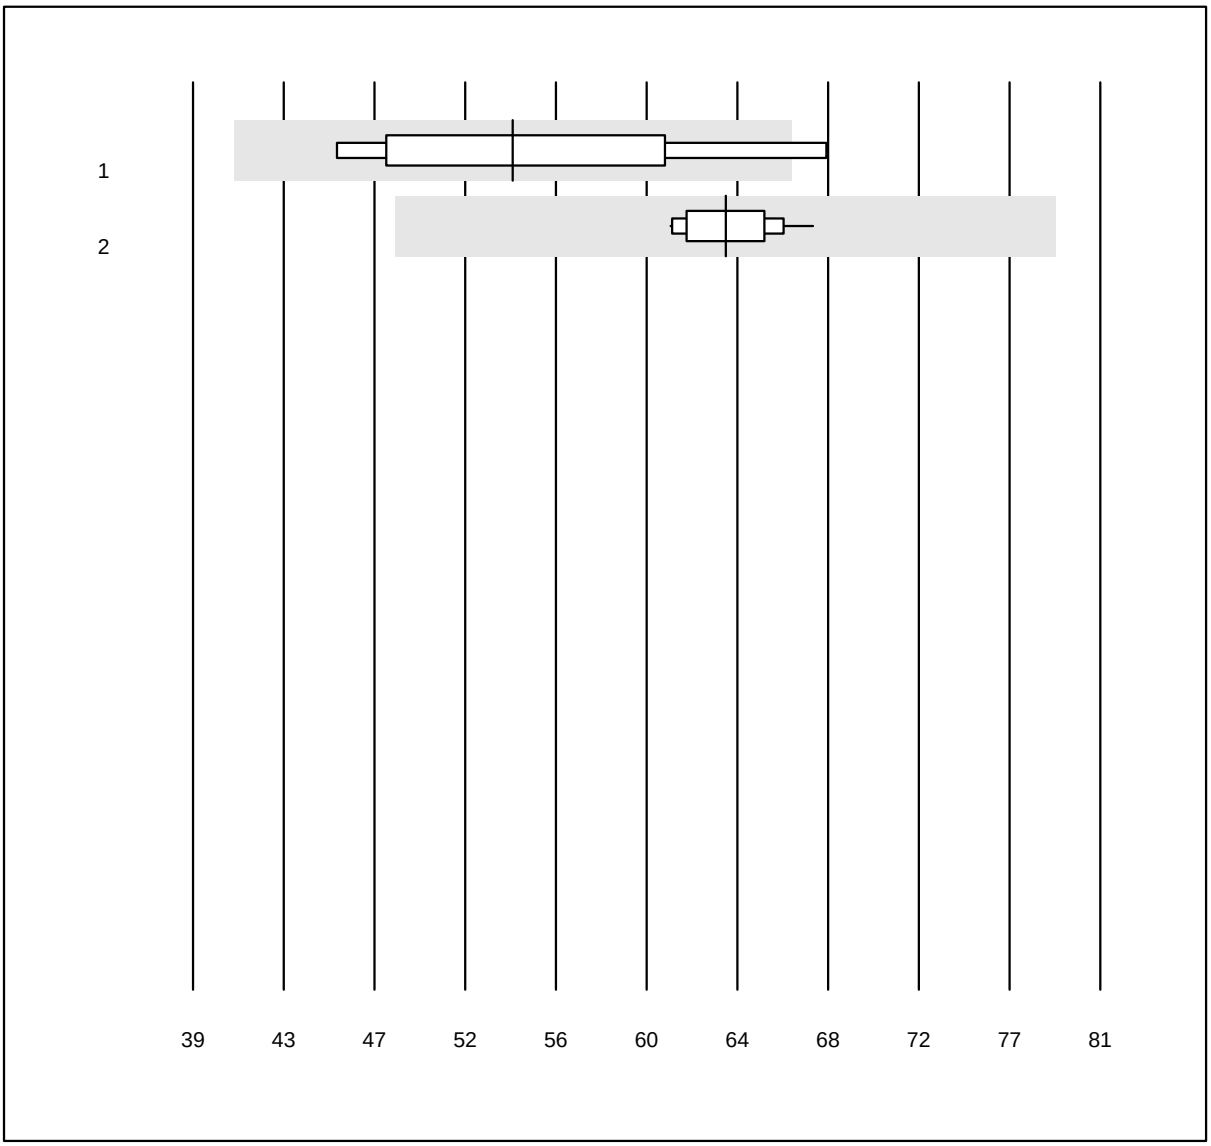


QUALAB Toleranz: 24%

Prolactine (PRL) (µg/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	5	100.0	0.0	0.0	53.8	13.1	d*
2	Cobas/Roche	17	100.0	0.0	0.0	63.7	3.1	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

SHBG

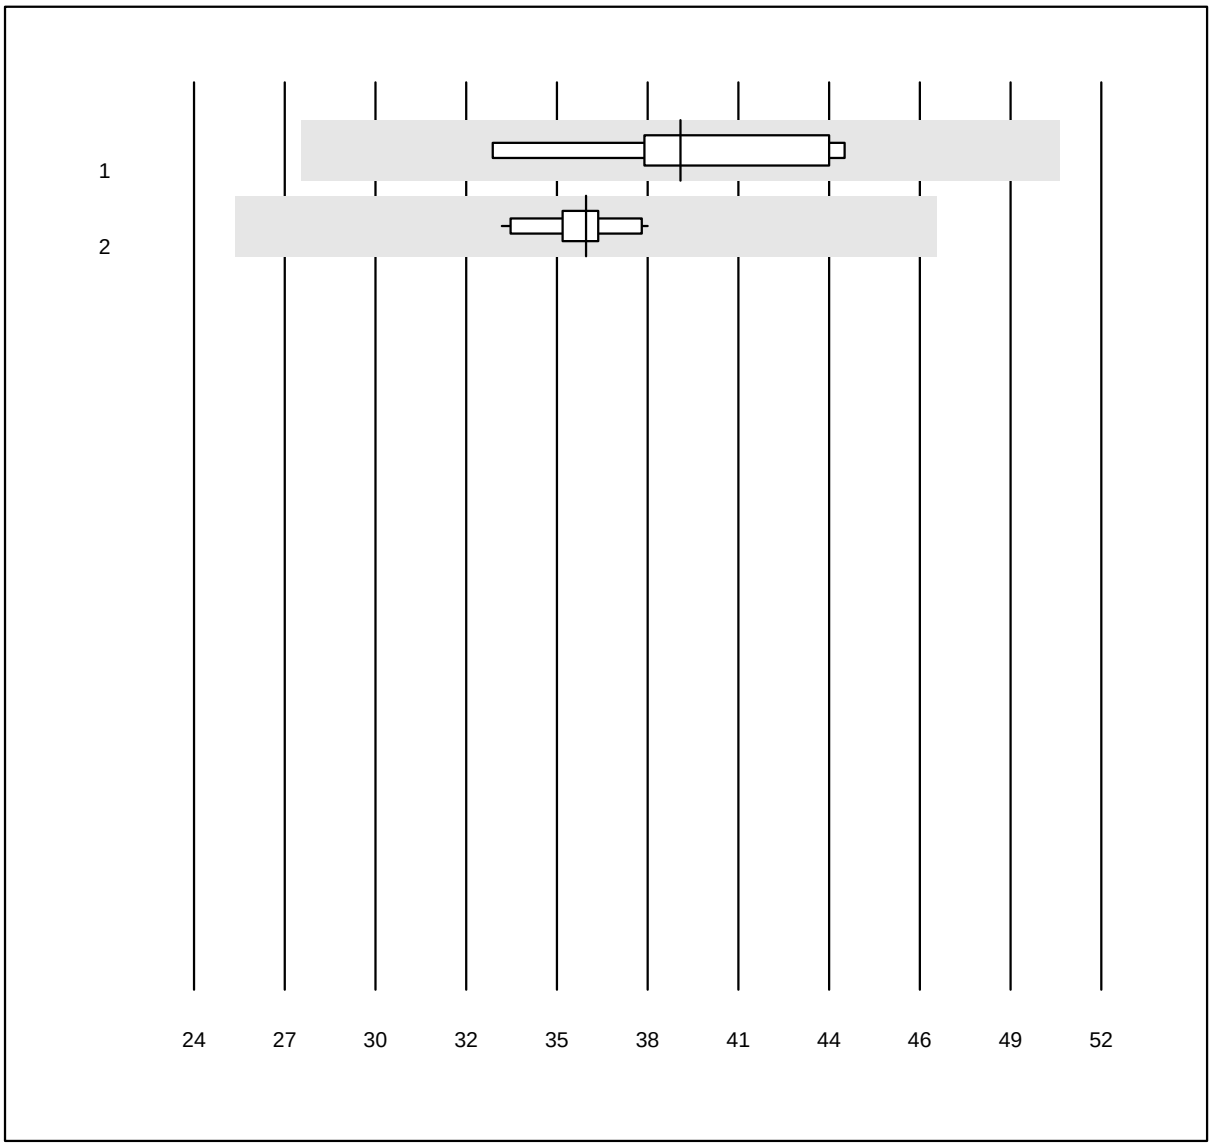


MQ Toleranz: 30%

SHBG (nmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	7	100.0	0.0	0.0	39.0	8.8	e
2	Roche	18	100.0	0.0	0.0	36.1	3.3	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

IGF-1

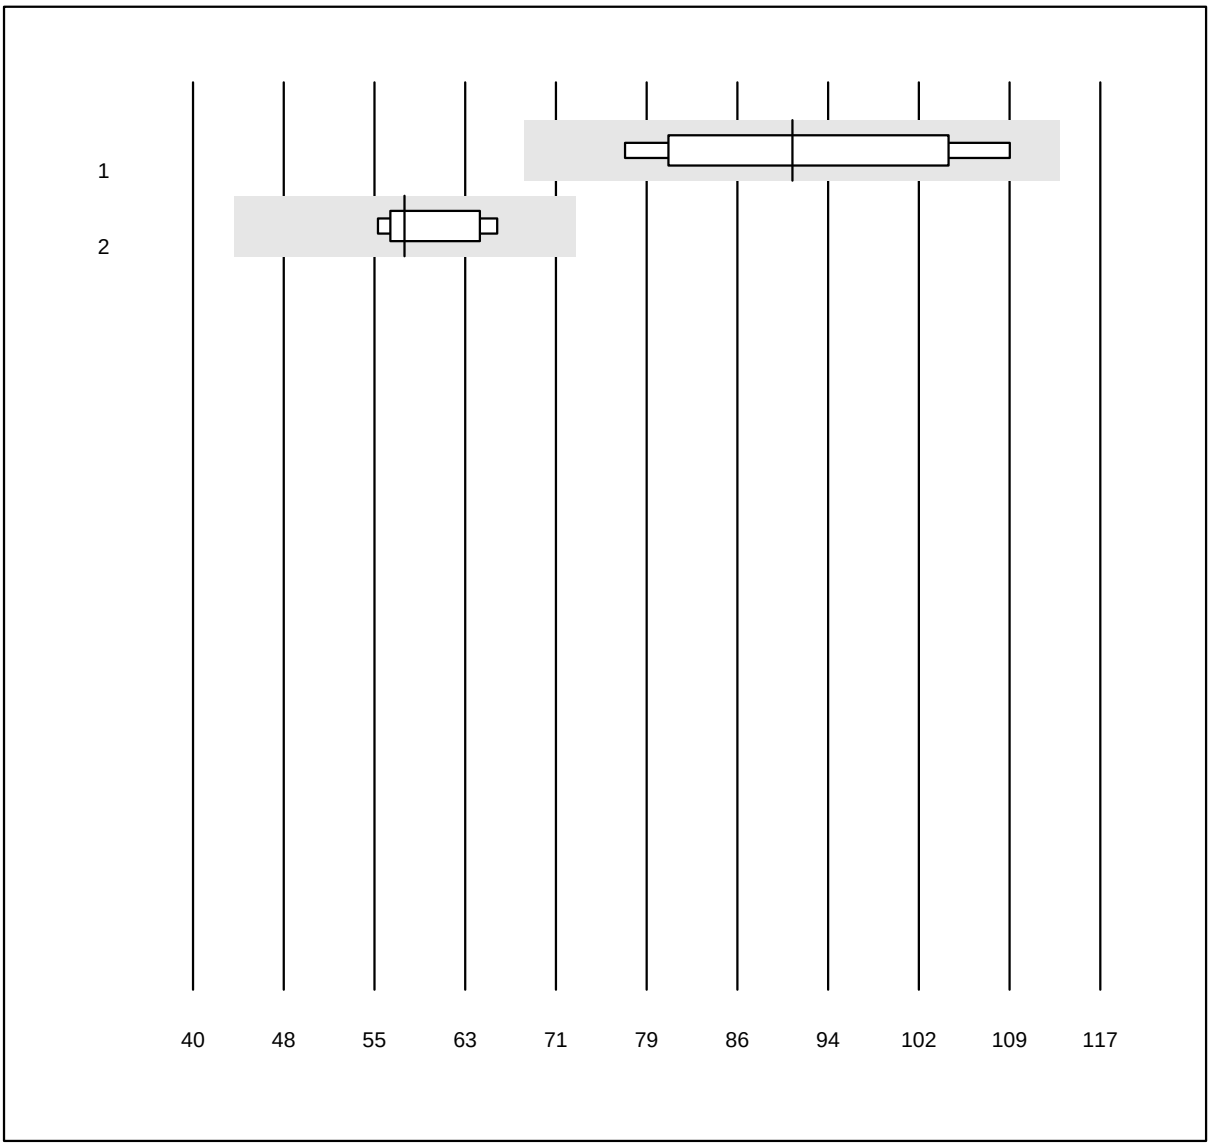


MQ Toleranz: 25%

IGF-1 (µg/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Liaison	8	100.0	0.0	0.0	91	13.1	e*
2	Autres méthodes	6	100.0	0.0	0.0	58	6.7	e

Testostérone

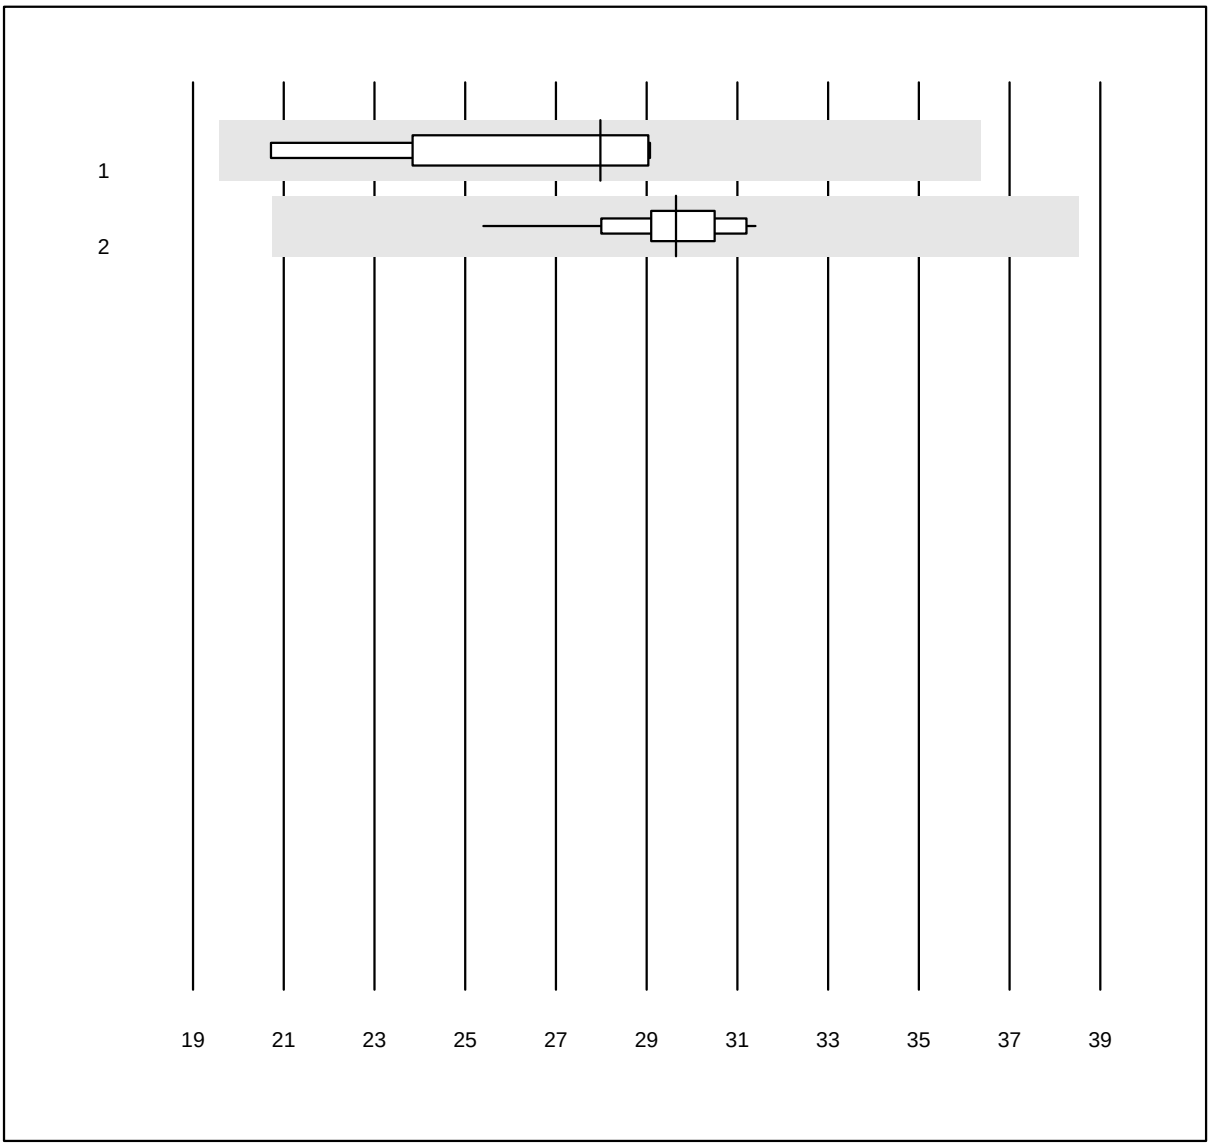


QUALAB Toleranz: 30%

Testostérone (nmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	4	100.0	0.0	0.0	28.0	10.9	e*
2	Roche	19	100.0	0.0	0.0	29.6	4.6	e

3 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Testostérone libre

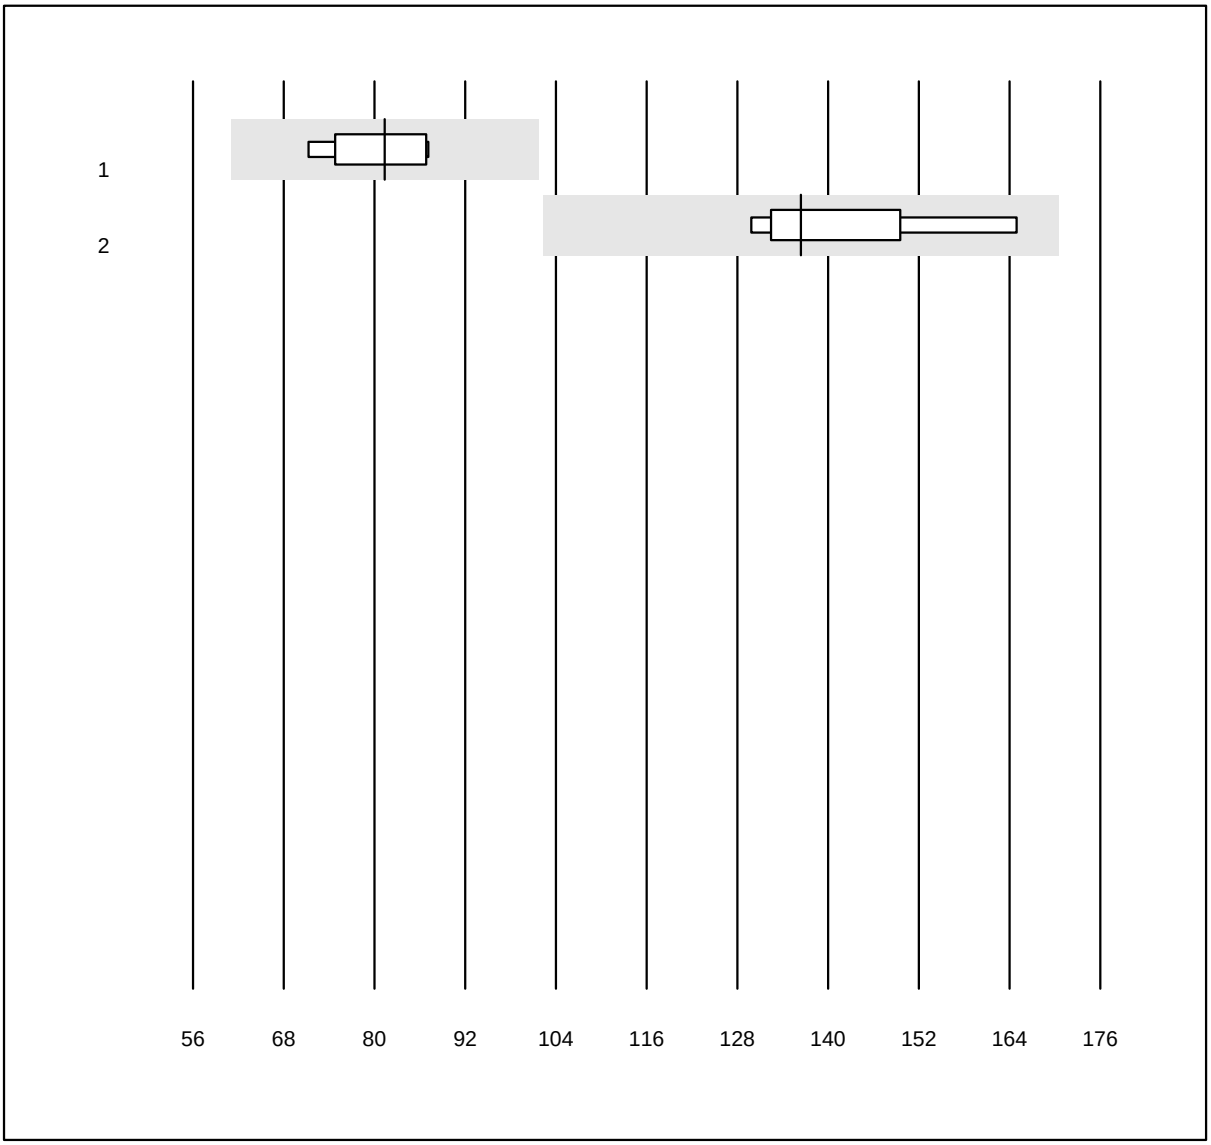


MQ Toleranz: 25%

Testostérone libre (pmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	IDS	5	100.0	0.0	0.0	81.4	7.6	e*
2	Autres méthodes	5	100.0	0.0	0.0	136.4	7.8	e*

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

T3

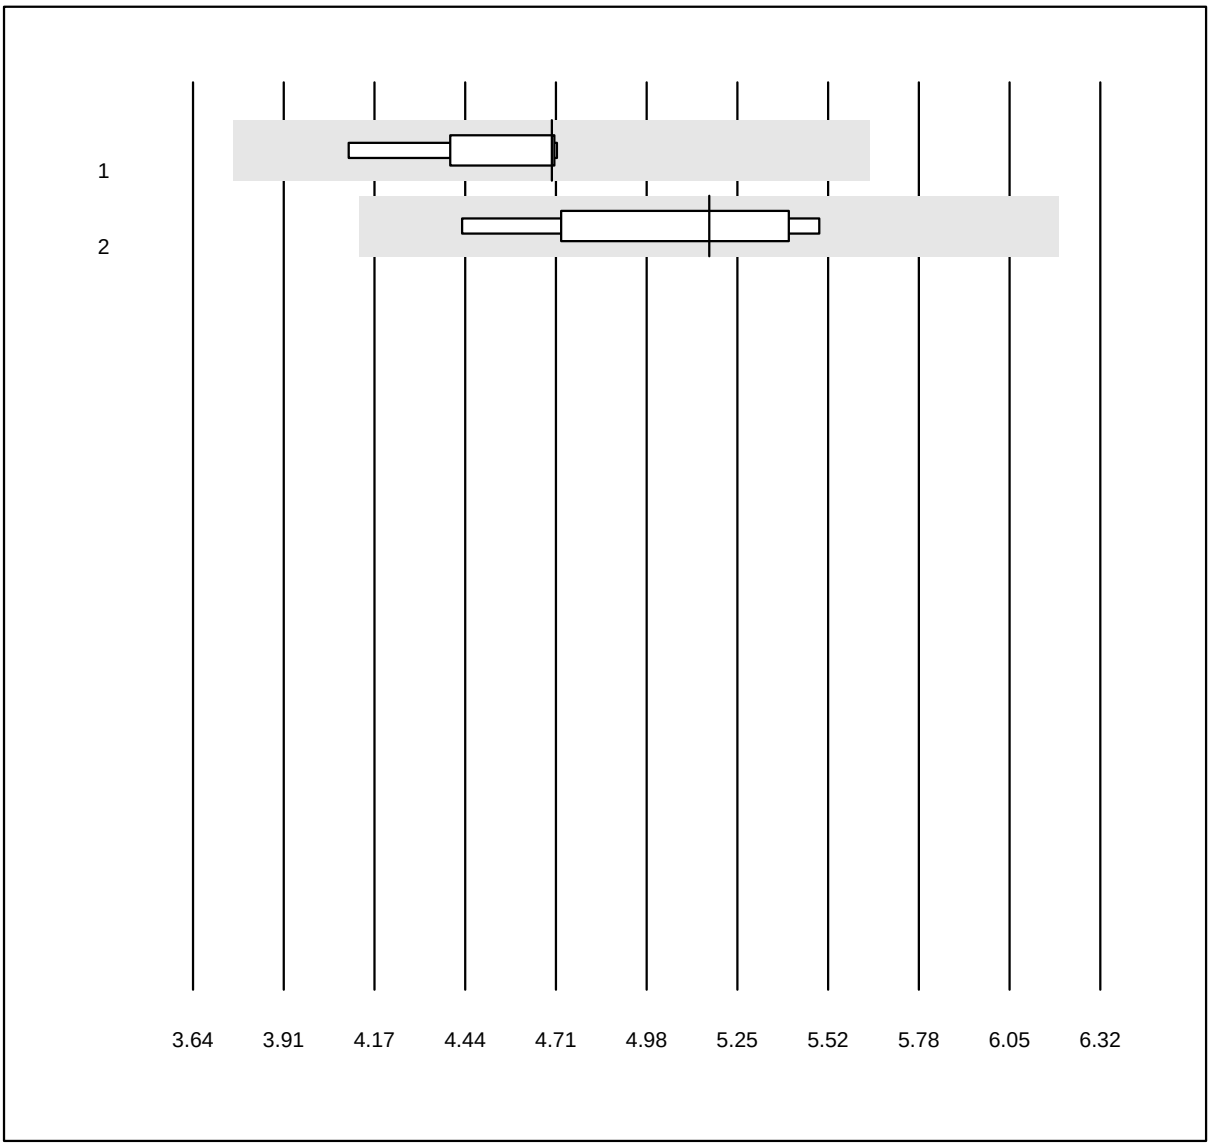


MQ Toleranz: 20%

T3 (nmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	4	100.0	0.0	0.0	4.7	4.4	e
2	AFIAS	4	100.0	0.0	0.0	5.2	7.0	e*

FT3

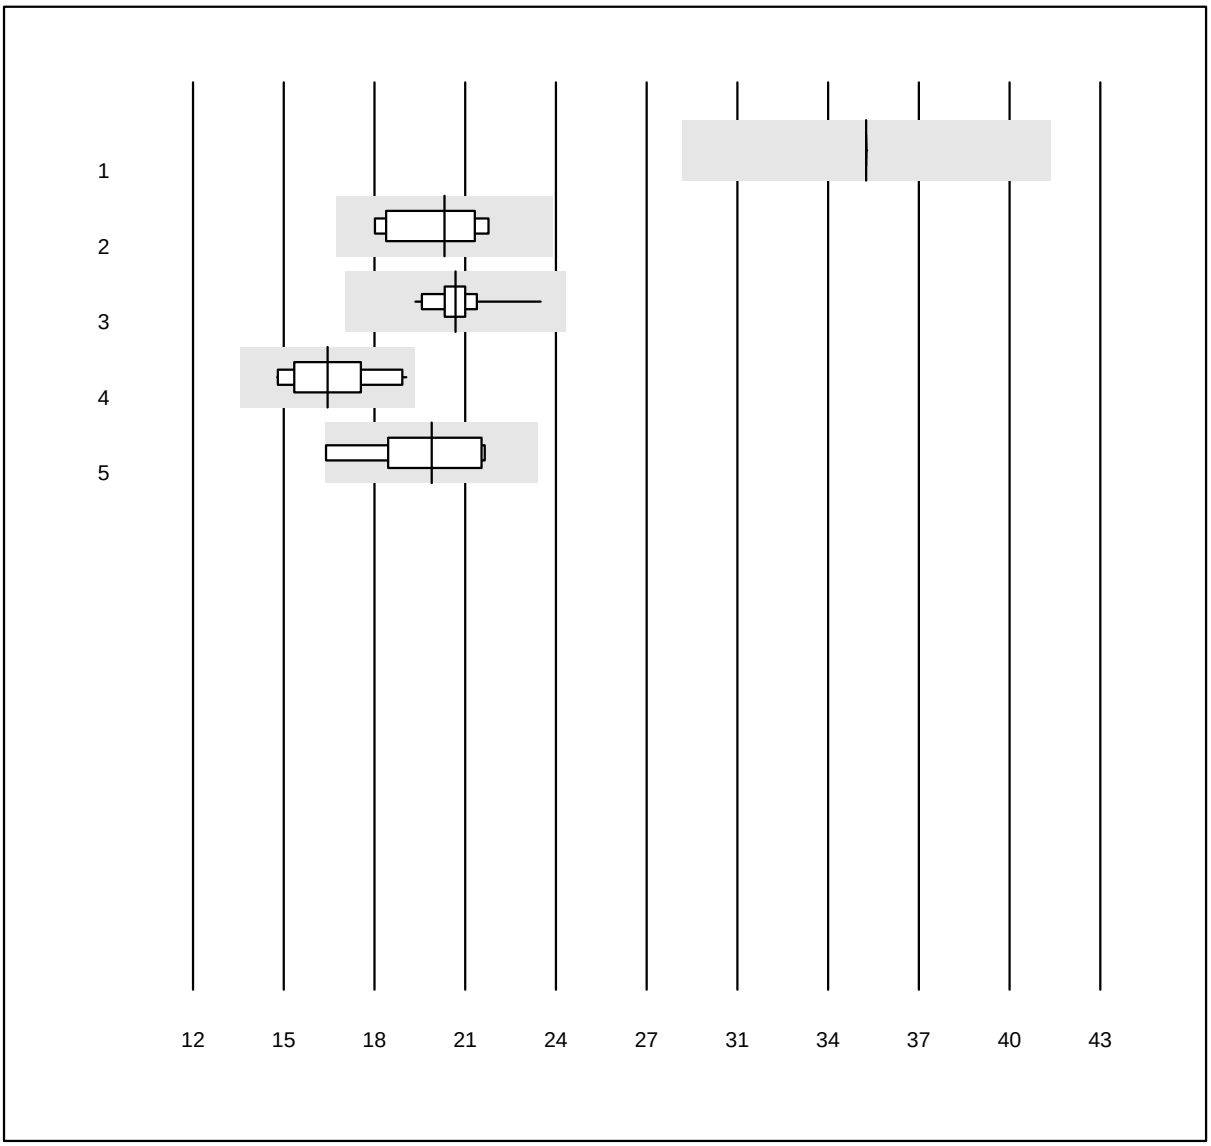


QUALAB Toleranz: 18%

FT3 (pmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Vitros	5	100.0	0.0	0.0	35.0	0.0	e
2	Abbott	7	100.0	0.0	0.0	20.6	7.5	e*
3	Roche	31	100.0	0.0	0.0	21.0	4.2	e
4	Siemens	10	100.0	0.0	0.0	16.6	8.2	e*
5	VIDAS	7	100.0	0.0	0.0	20.2	9.4	e*

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

T4

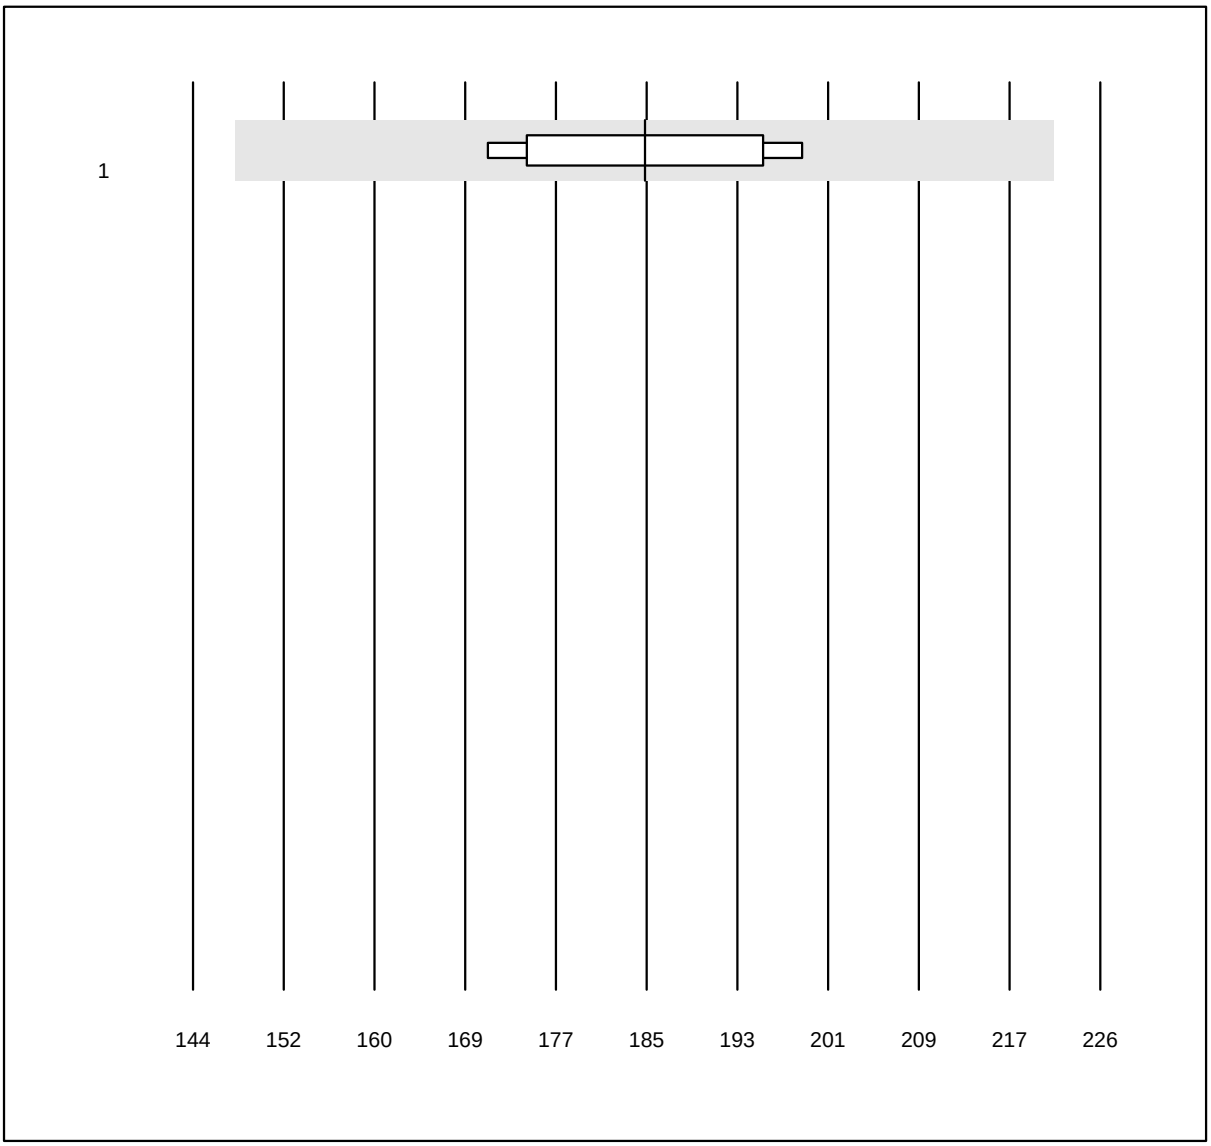


MQ Toleranz: 20%

T4 (nmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	4	100.0	0.0	0.0	185	6.1	e*

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

FT4

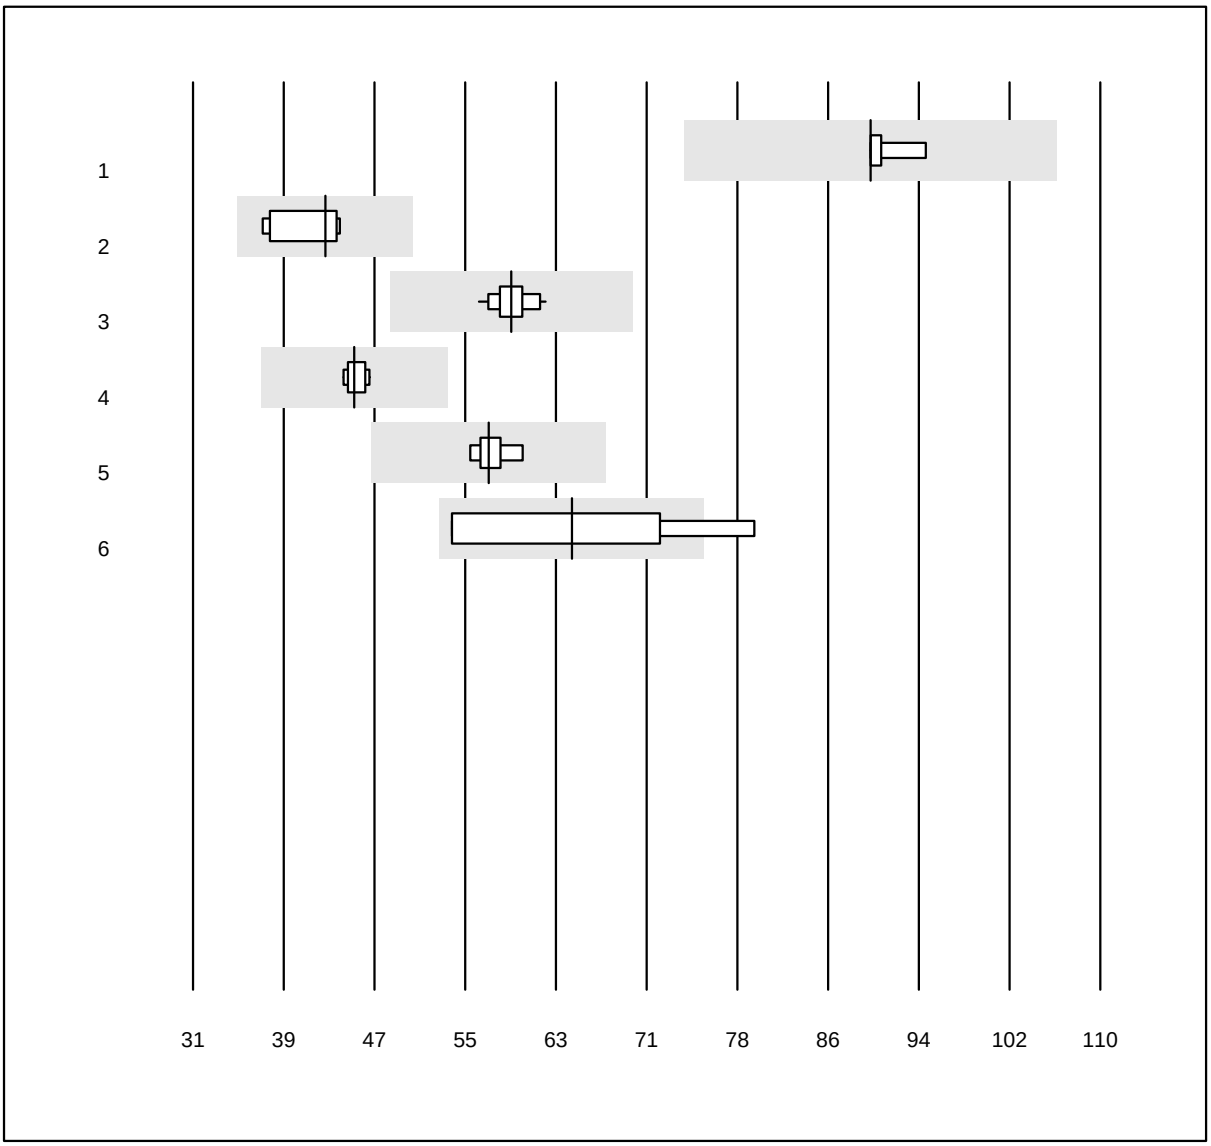


QUALAB Toleranz: 18%

FT4 (pmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Vitros	6	100.0	0.0	0.0	90.0	1.7	e
2	Abbott	7	85.7	0.0	14.3	42.5	6.9	e*
3	Roche	32	100.0	0.0	0.0	58.7	2.6	e
4	Siemens	10	100.0	0.0	0.0	45.0	1.8	e
5	VIDAS	8	100.0	0.0	0.0	56.8	2.3	e
6	Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	64.0	16.2	a*

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

TSH

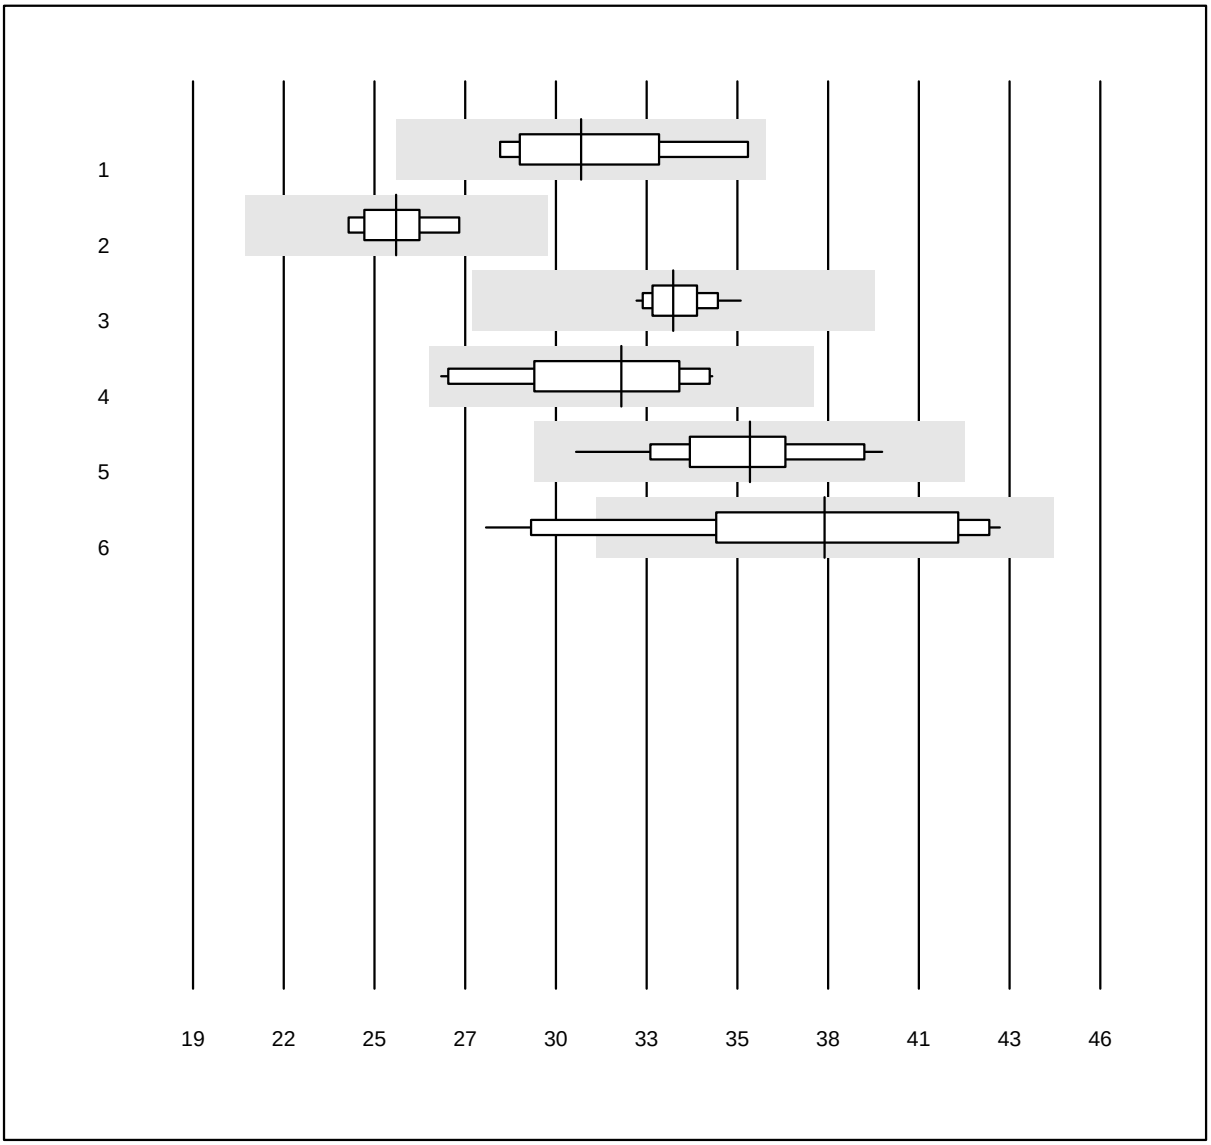


QUALAB Toleranz: 18%

TSH (mU/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Vitros	5	100.0	0.0	0.0	30.55	7.6	e*
2	Abbott	7	100.0	0.0	0.0	25.04	4.2	e
3	Roche	38	100.0	0.0	0.0	33.29	2.5	e
4	Siemens	10	100.0	0.0	0.0	31.75	8.3	e*
5	VIDAS	16	100.0	0.0	0.0	35.57	6.4	e
6	AFIAS	12	91.7	8.3	0.0	37.80	12.4	e*

3 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Troponine T CR

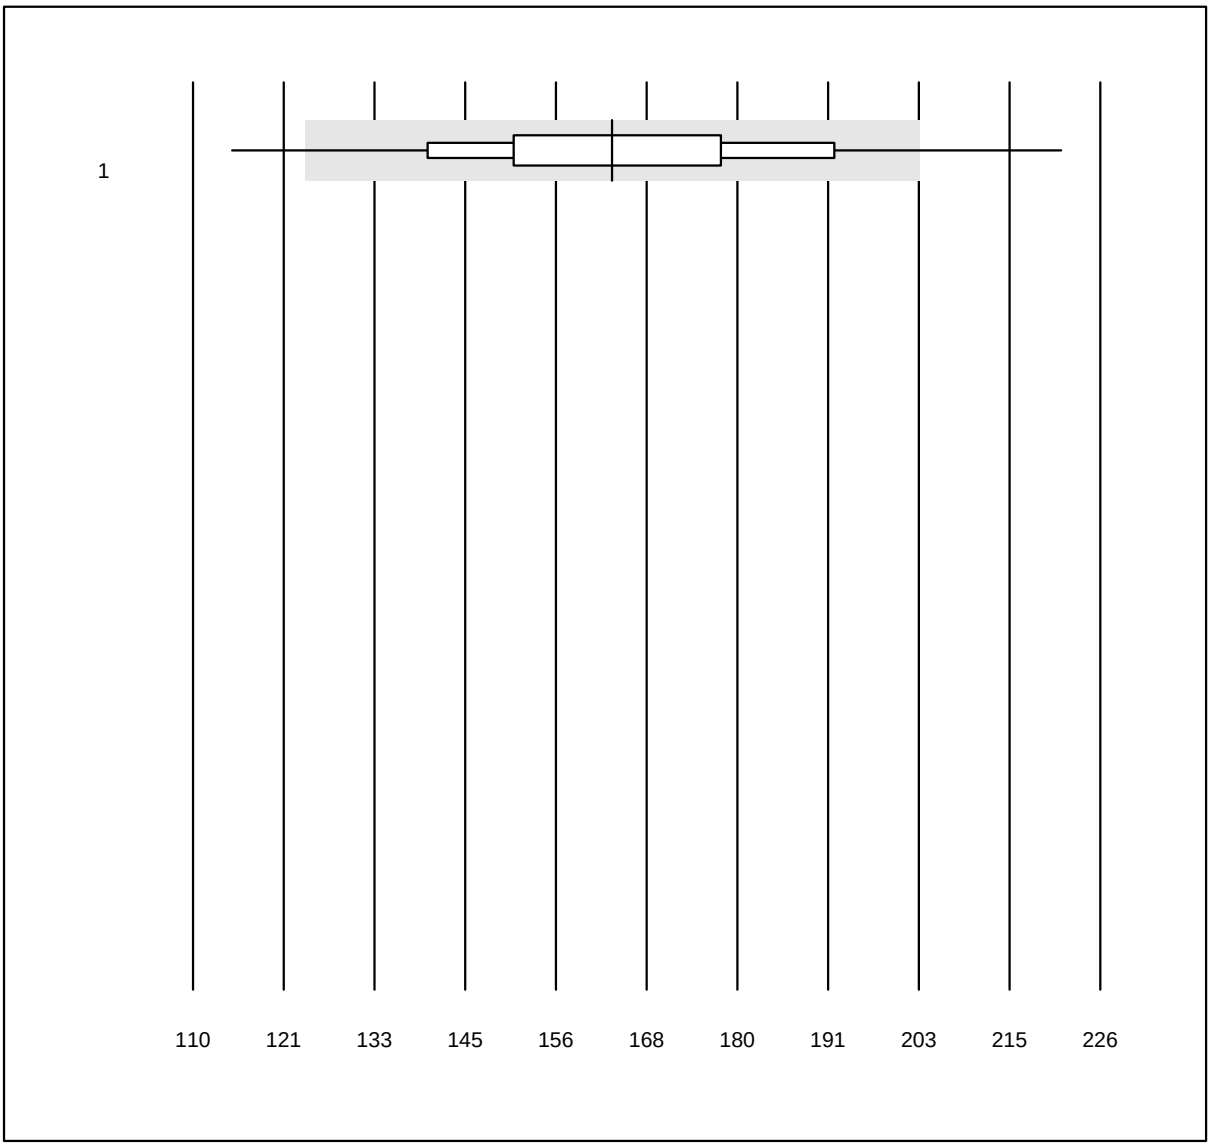


MQ Toleranz: 24%

Troponine T CR (ng/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Cobas h 232	229	90.4	7.4	2.2	163.58	12.4	e

NT-proBNP CR

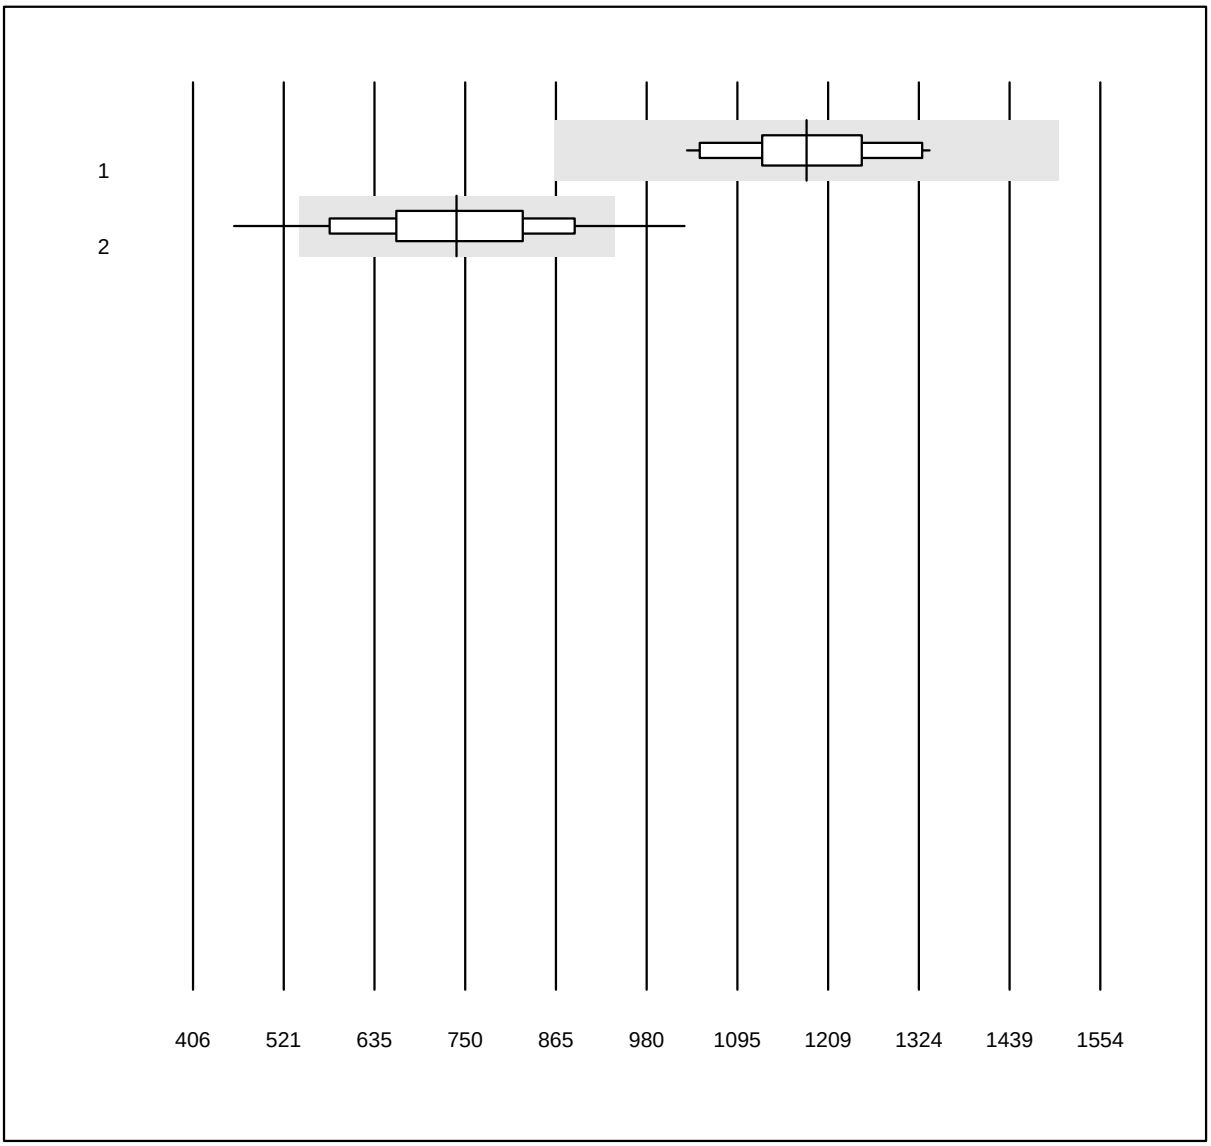


QUALAB Toleranz: 27%

NT-proBNP CR (ng/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Lumira Dx	13	92.3	0.0	7.7	1182	7.4	e
2	Cobas h 232	278	88.5	9.4	2.2	739	15.7	e

D-Dimères CR

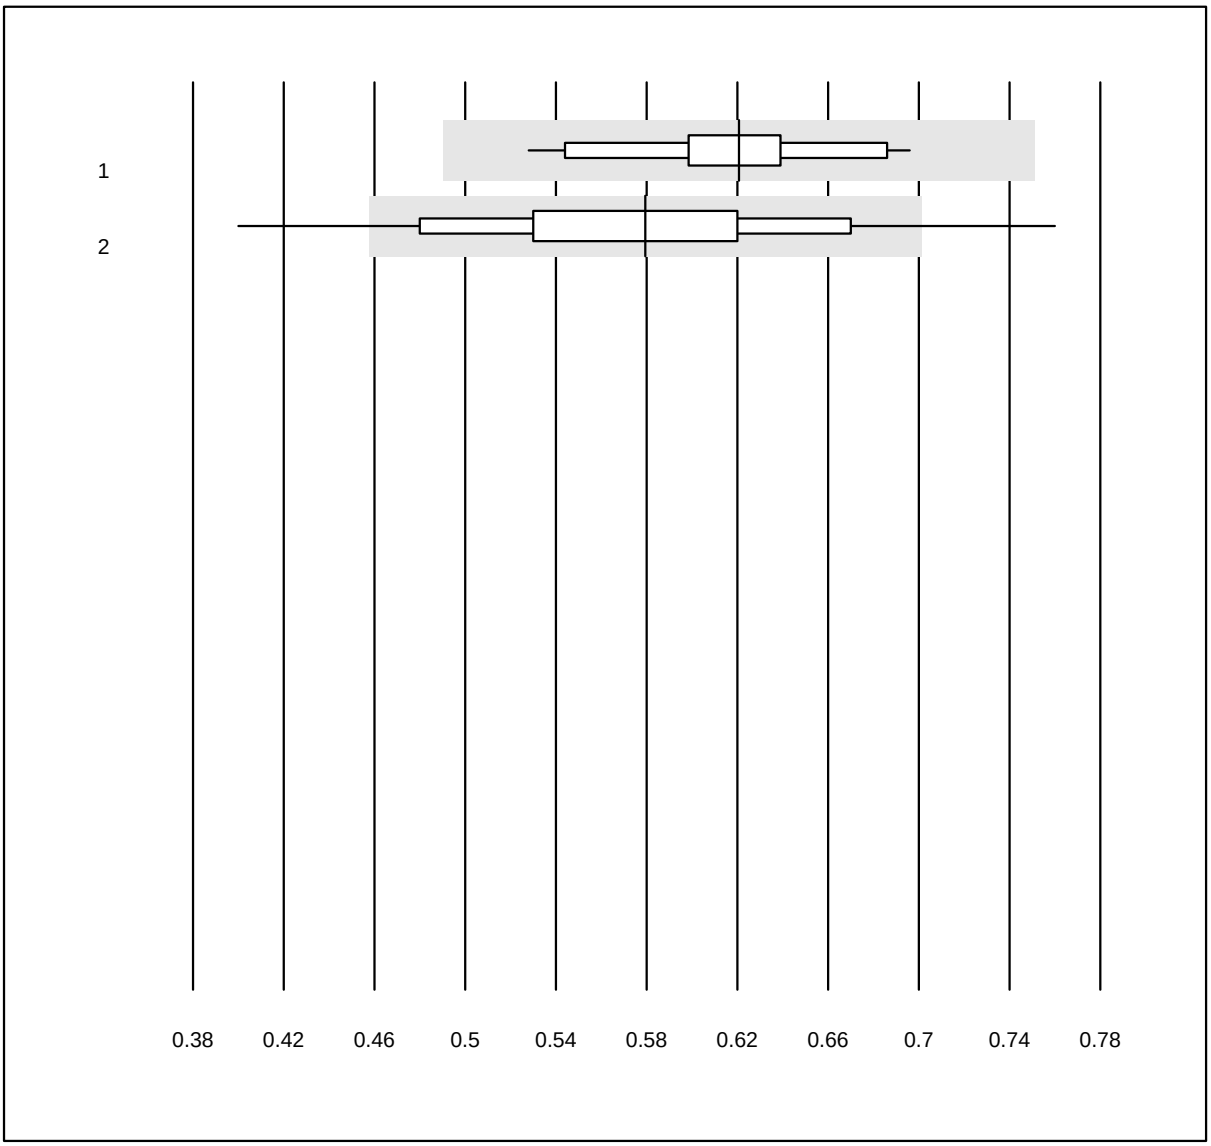


QUALAB Toleranz: 21%

D-Dimères CR (mg/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Lumira Dx	15	93.3	0.0	6.7	0.62	7.0	e
2	Cobas h 232	506	90.9	7.5	1.6	0.58	11.8	e

PO2 CCA

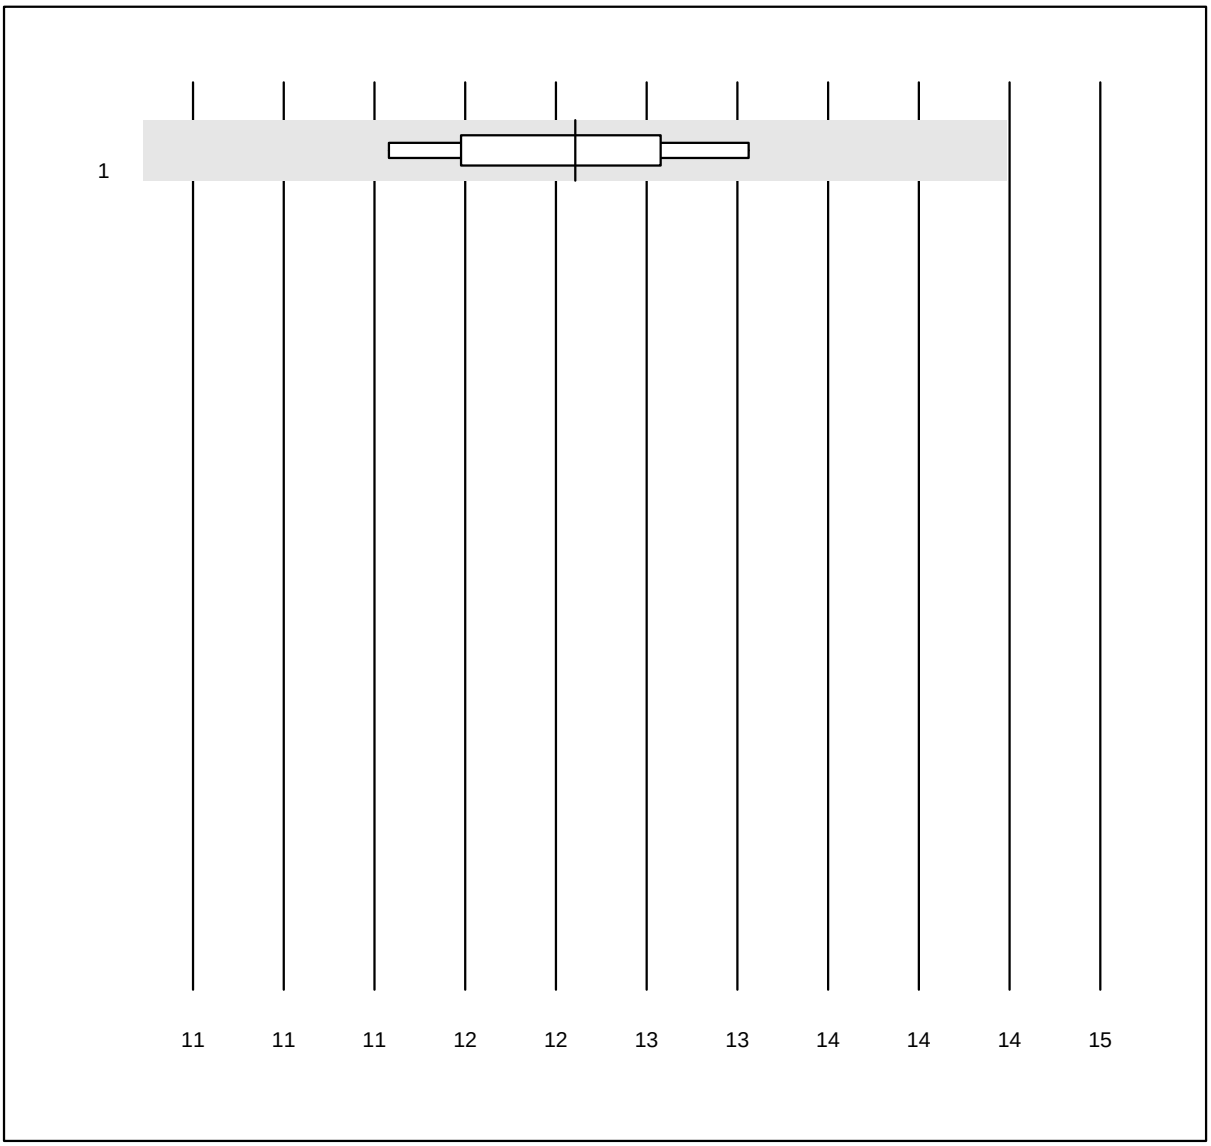


QUALAB Toleranz: 15%

PO2 CCA (kPa)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	OPTI CCA	9	100.0	0.0	0.0	12.69	4.1	e

PCO2 CCA

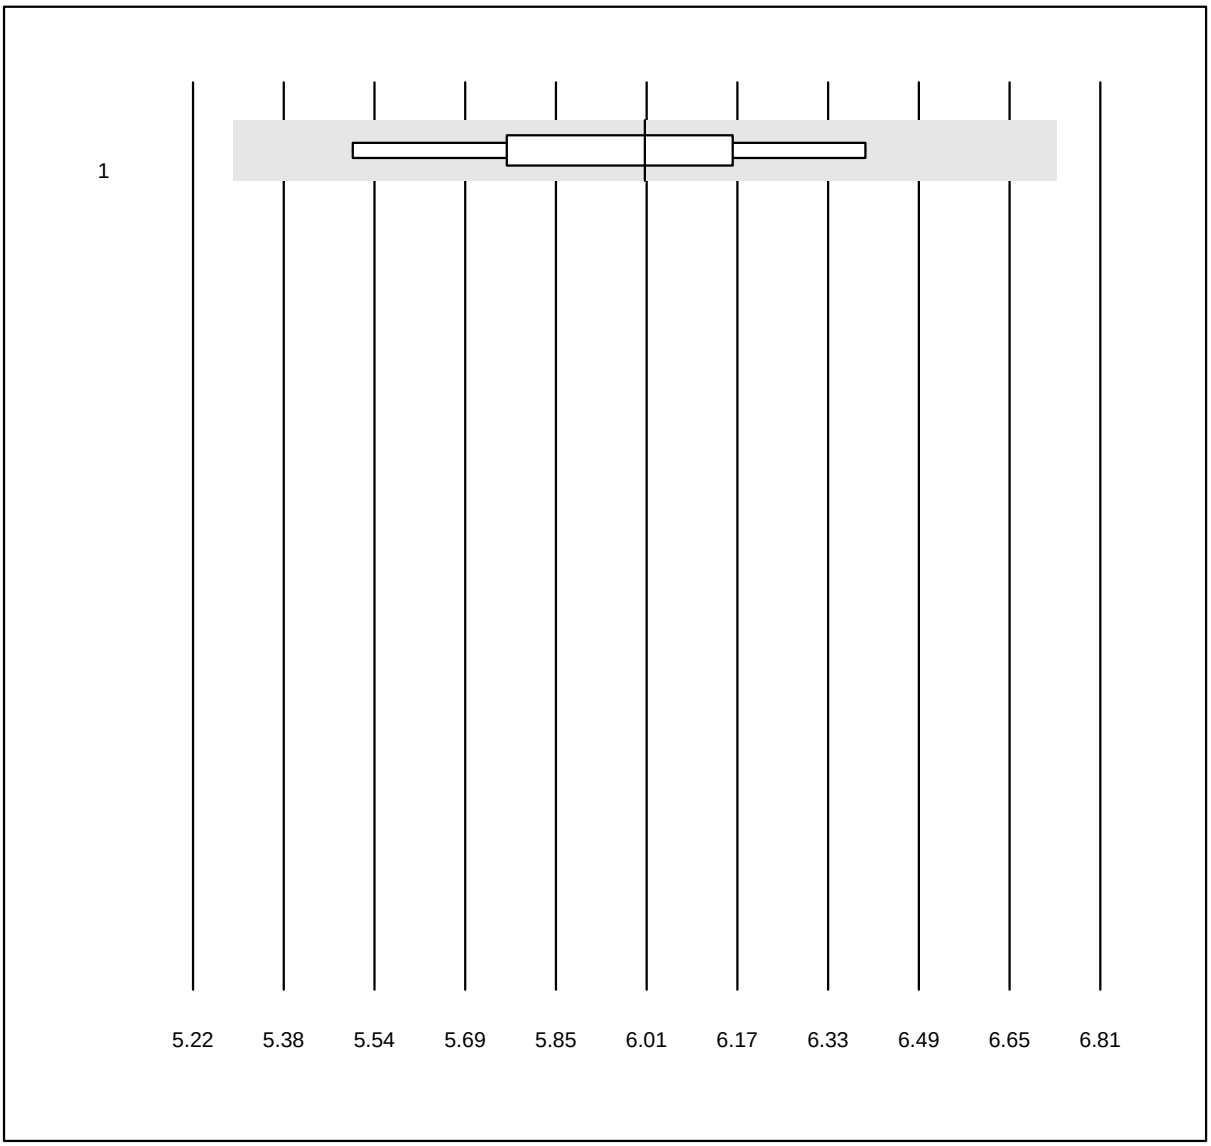


QUALAB Toleranz: 12%

PCO2 CCA (kPa)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	OPTI CCA	9	100.0	0.0	0.0	6.01	4.8	e*

pH CCA

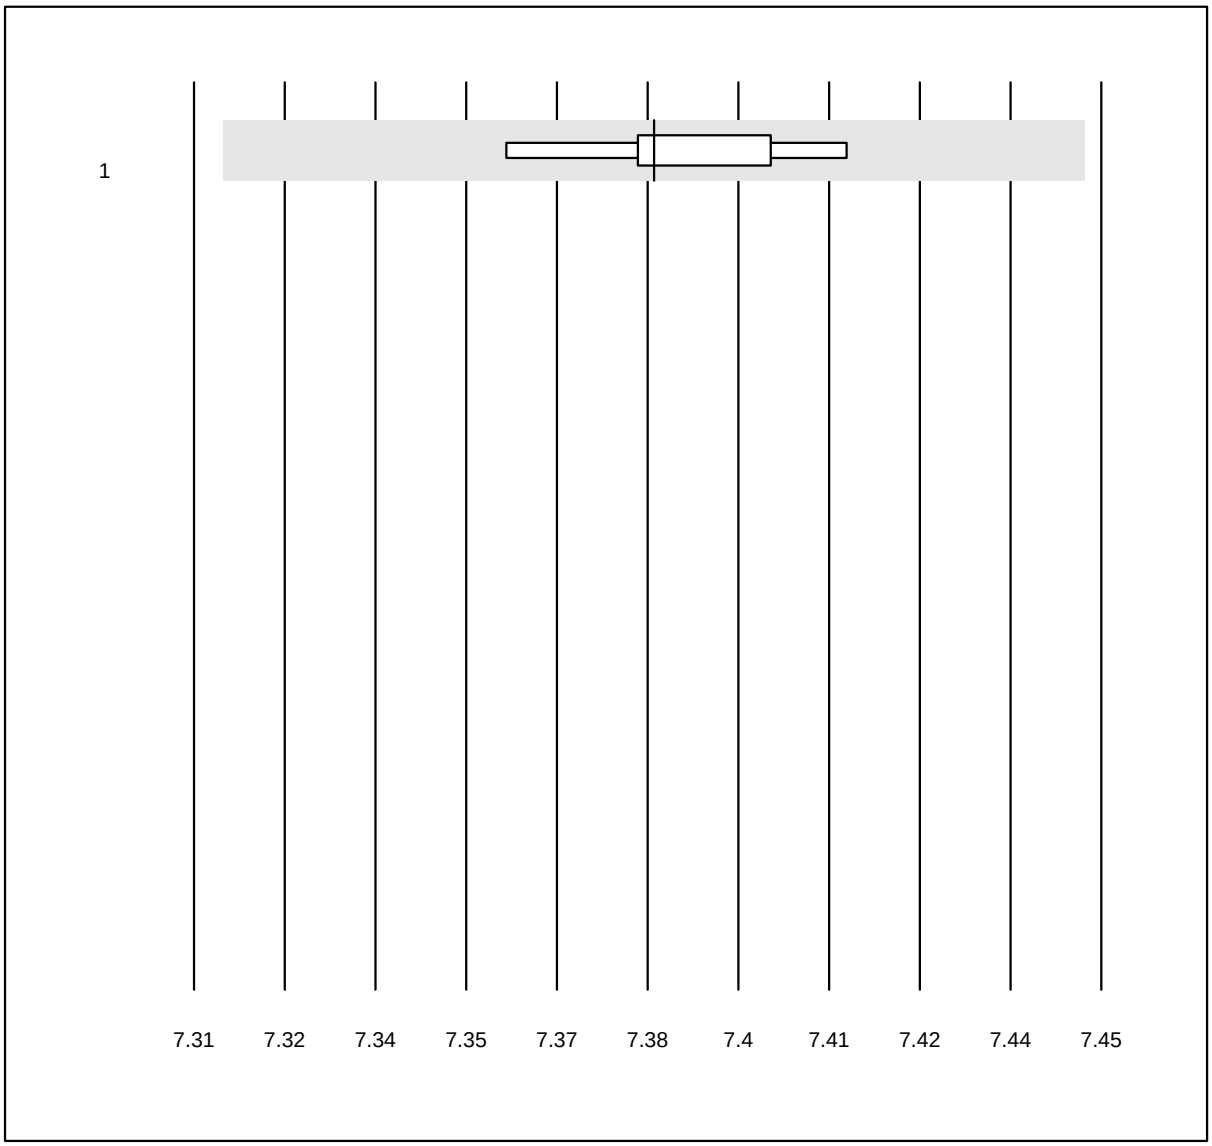


QUALAB Toleranz: 0% pH CCA ()

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	OPTI CCA	8	100.0	0.0	0.0	7.38	0.2	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Sodium CCA

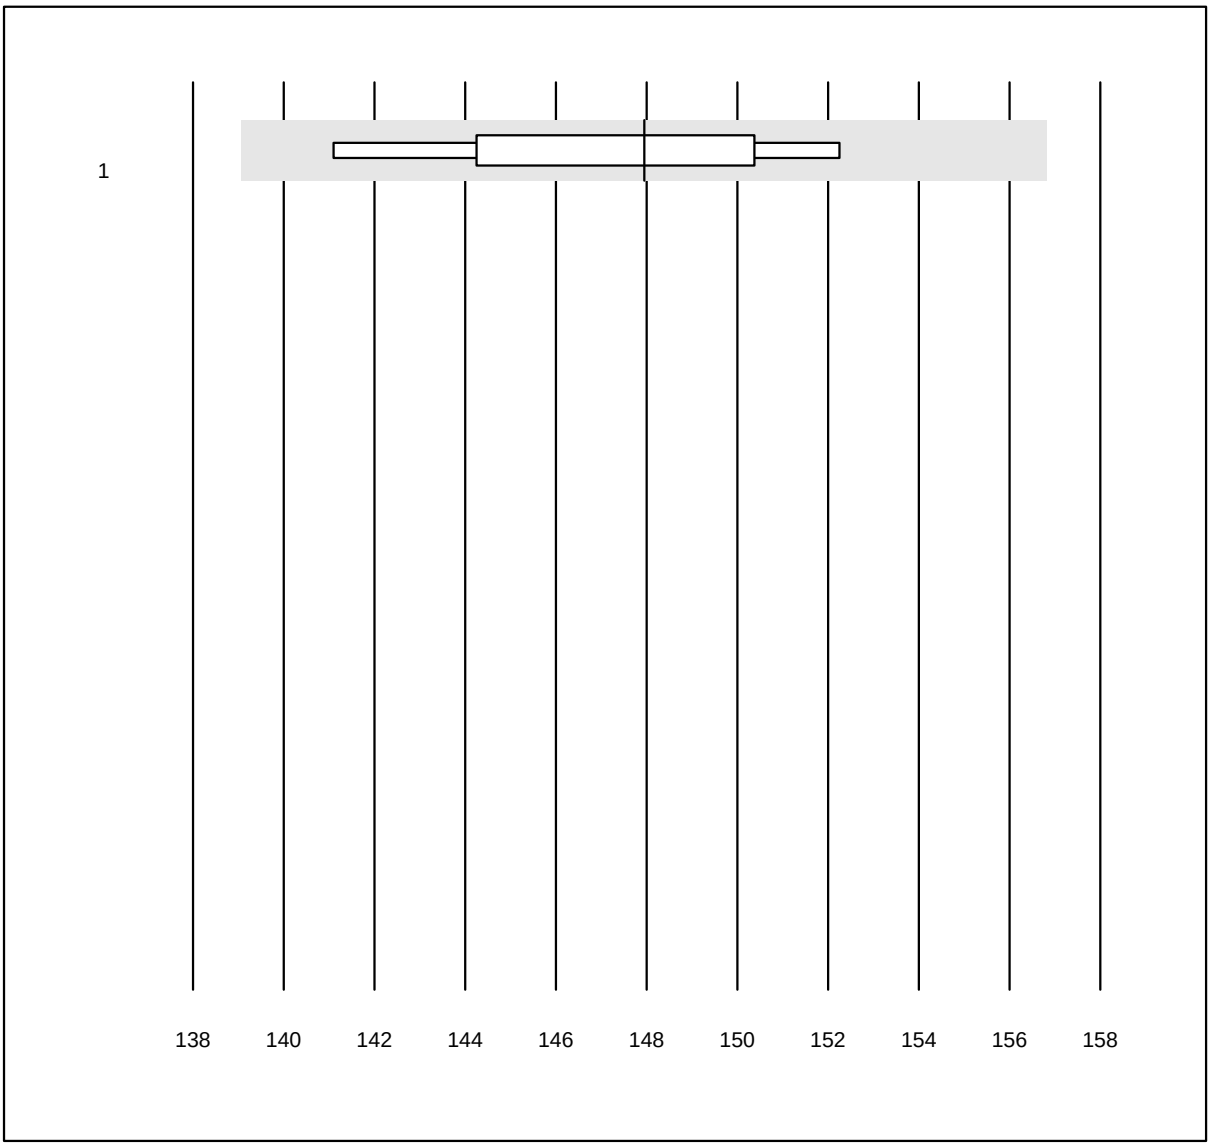


QUALAB Toleranz: 6%

Sodium CCA (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	OPTI CCA	4	100.0	0.0	0.0	147.9	2.2	e*

Potassium CCA

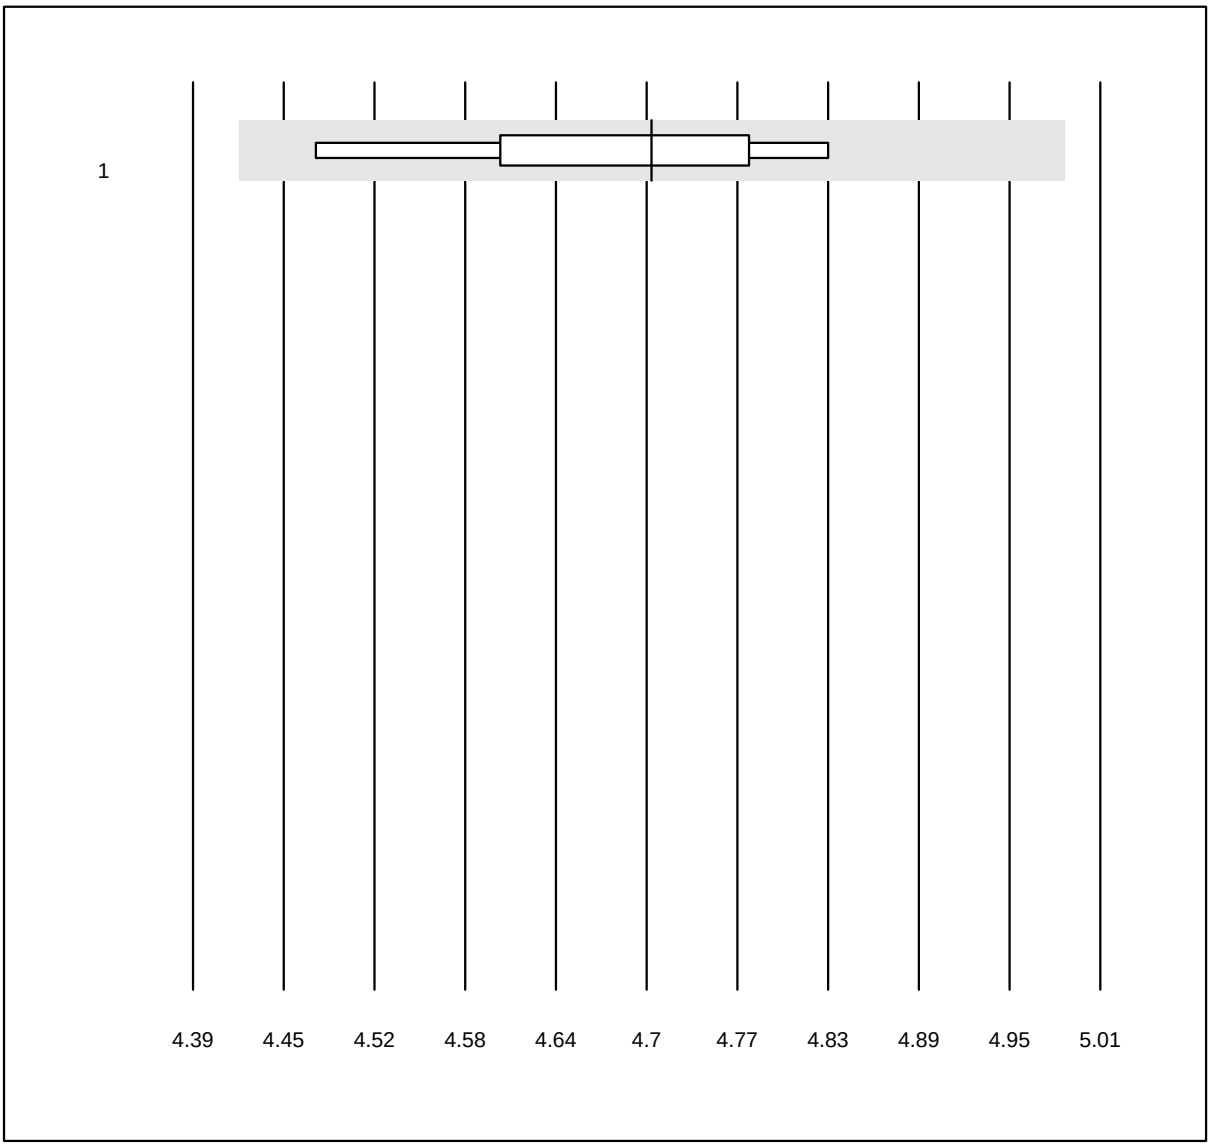


QUALAB Toleranz: 6%

Potassium CCA (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	OPTI CCA	5	100.0	0.0	0.0	4.7	2.2	e*

Ferritine

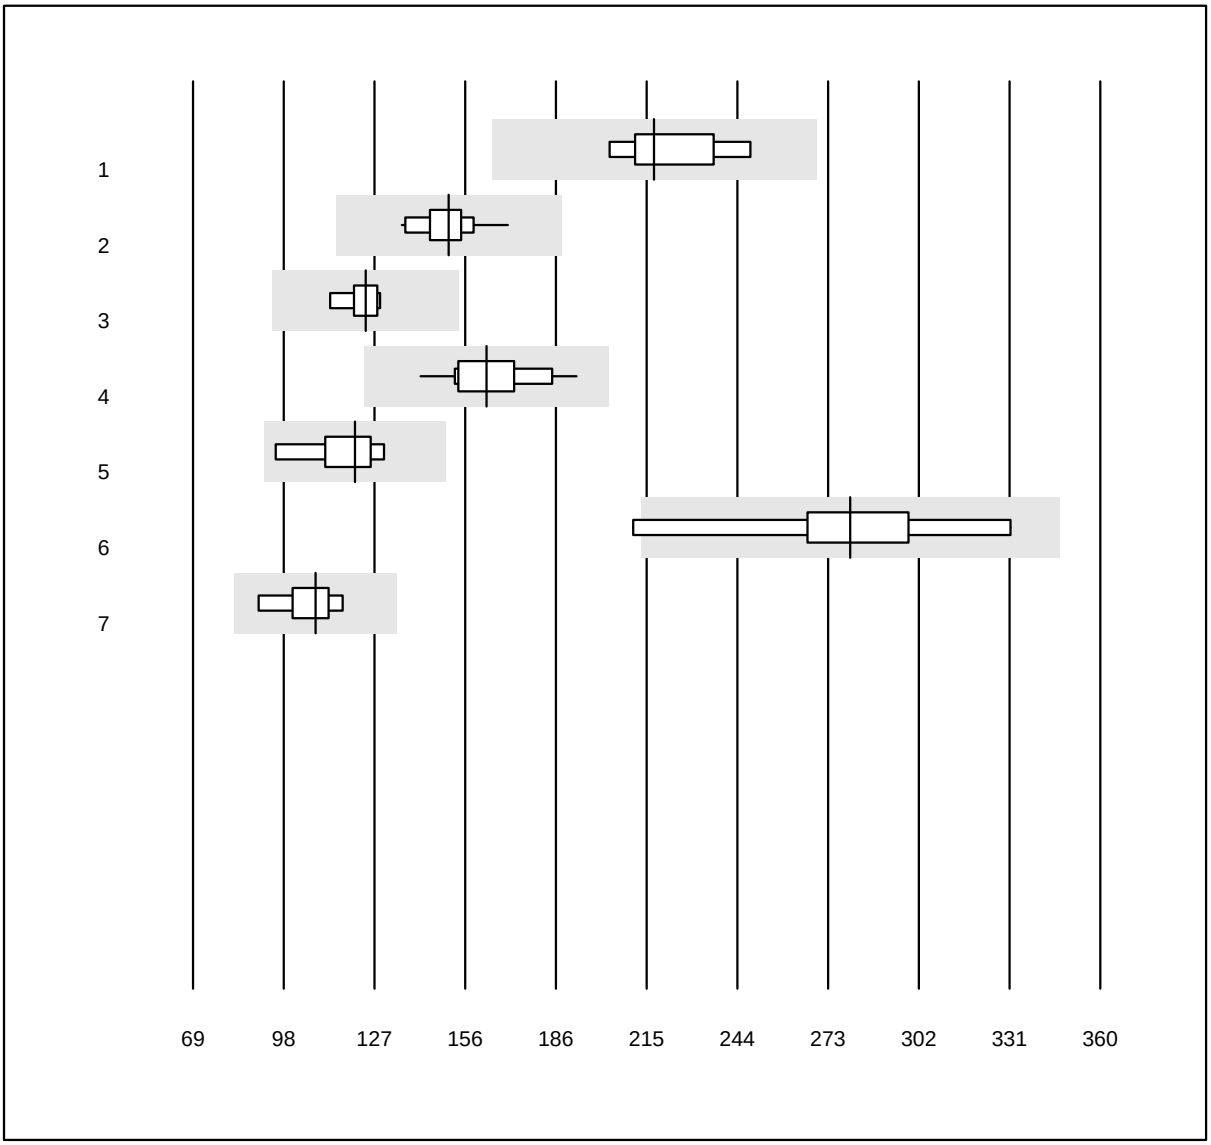


QUALAB Toleranz: 24%

Ferritine (µg/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	7	100.0	0.0	0.0	216.87	6.7	e
2	Roche	40	100.0	0.0	0.0	150.99	5.4	e
3	Siemens	9	100.0	0.0	0.0	124.40	4.2	e
4	AFIAS	21	100.0	0.0	0.0	163.14	7.5	e
5	Mini Vidas	8	100.0	0.0	0.0	120.97	9.1	e*
6	RapidReader Cube Reader	9	88.9	11.1	0.0	279.80	11.9	e*
7	Autres méthodes	5	100.0	0.0	0.0	108.33	6.9	e*

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Folate

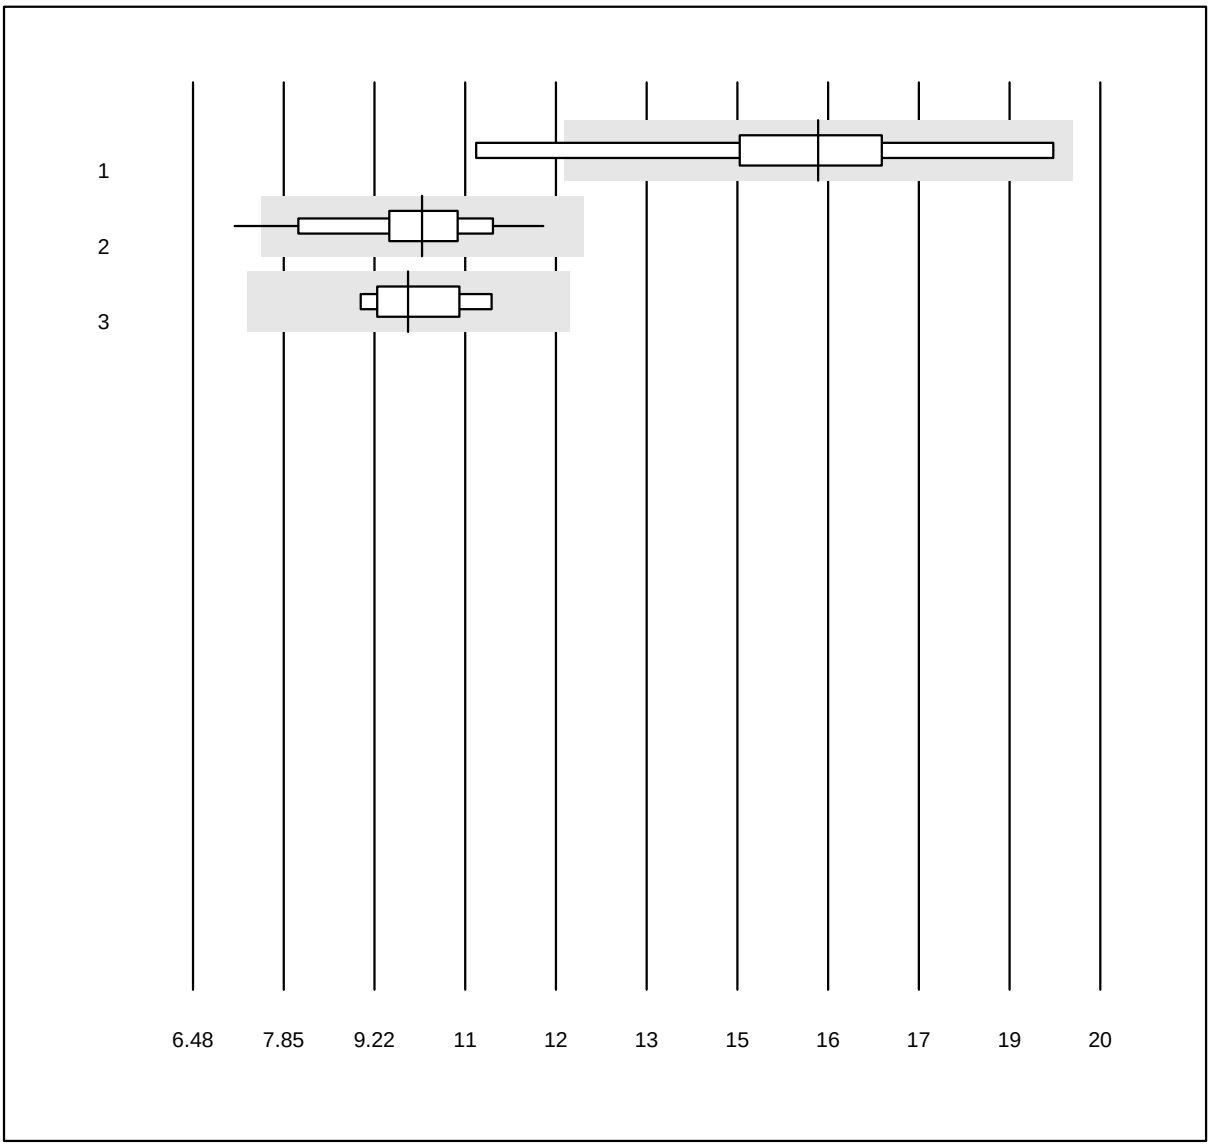


QUALAB Toleranz: 24%

Folate (nmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	9	88.9	11.1	0.0	15.80	14.9	e*
2	Roche	24	95.8	4.2	0.0	9.89	10.4	e
3	Siemens	8	100.0	0.0	0.0	9.69	6.9	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Vitamine B12

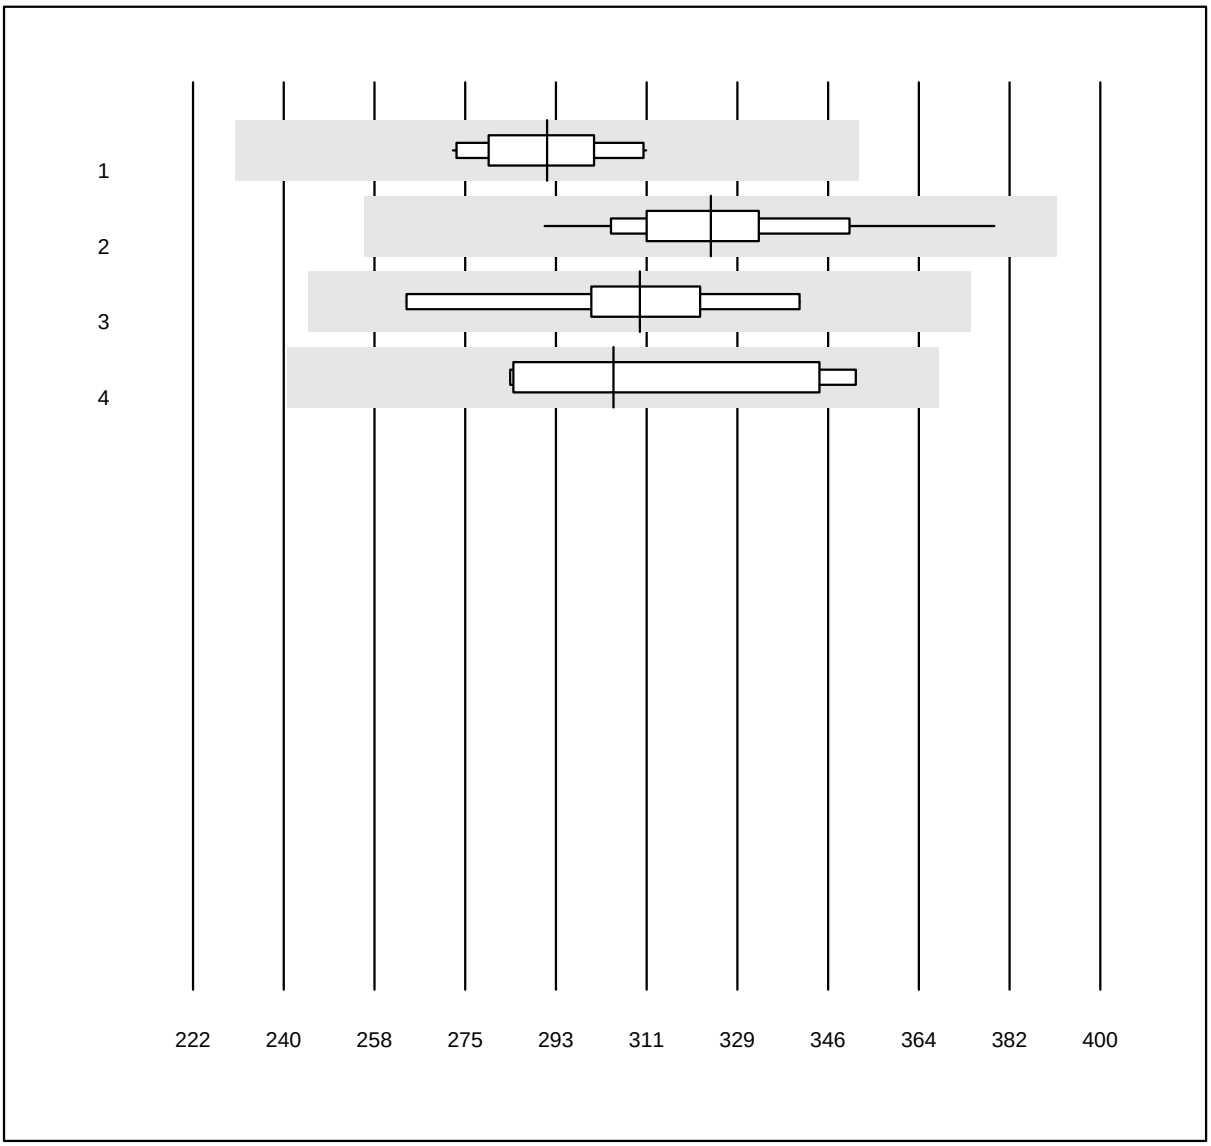


QUALAB Toleranz: 21%

Vitamine B12 (pmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	10	100.0	0.0	0.0	291.47	4.2	e
2	Roche	25	100.0	0.0	0.0	323.60	5.9	e
3	Siemens	9	100.0	0.0	0.0	309.67	6.9	e
4	Autres méthodes	6	100.0	0.0	0.0	304.50	9.1	e*

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Holotranscobalamine

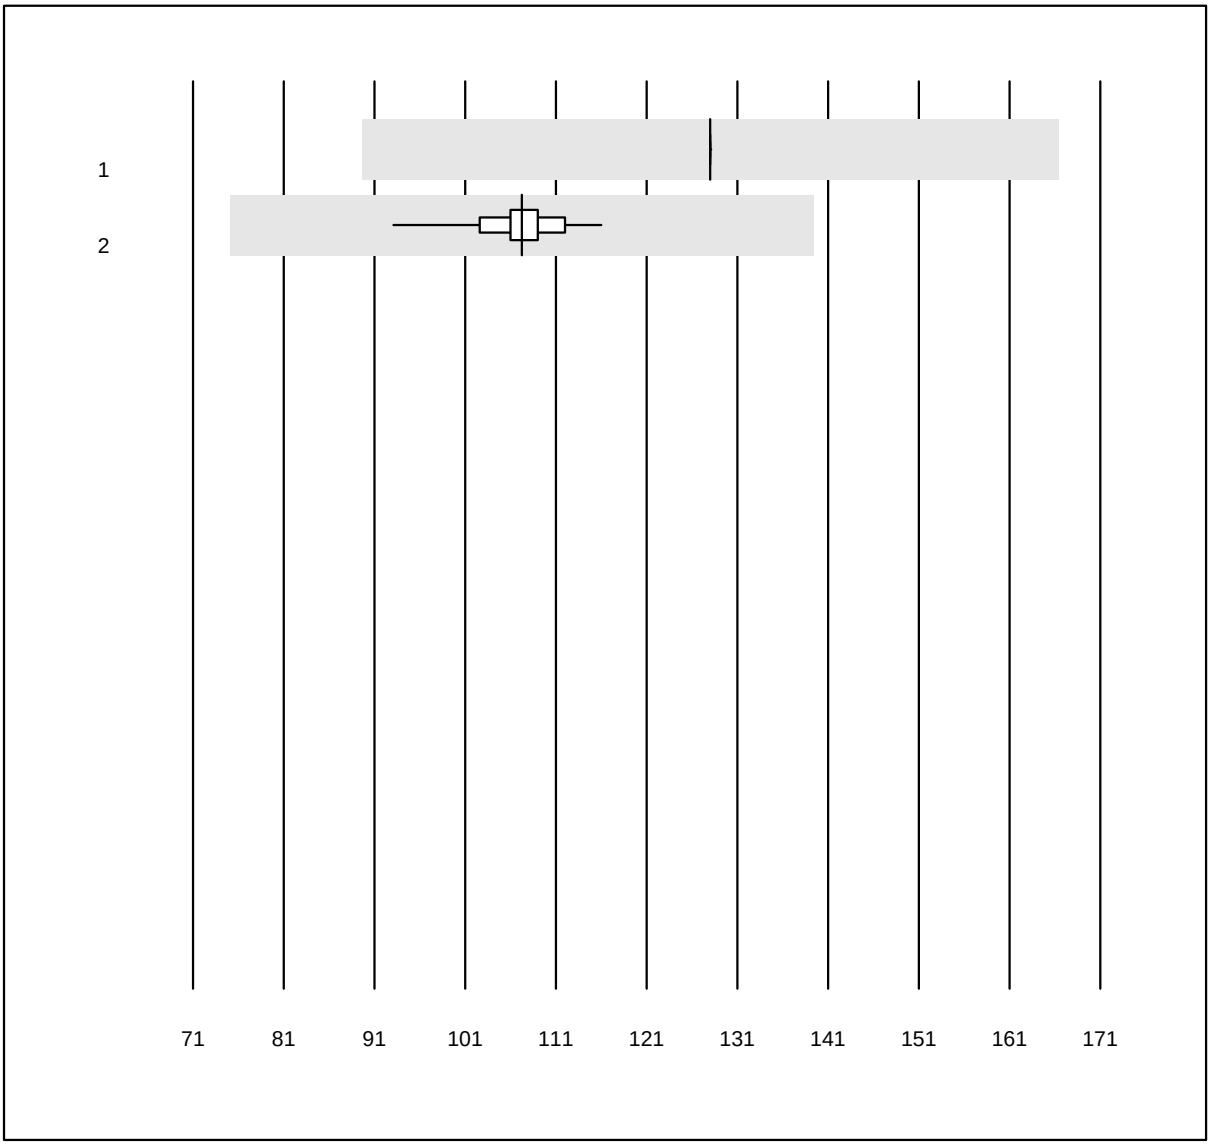


QUALAB Toleranz: 30%

Holotranscobalamine
(pmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	9	100.0	0.0	0.0	128.0	0.0	e
2	Cobas	47	100.0	0.0	0.0	107.2	3.8	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Bilirubin directe

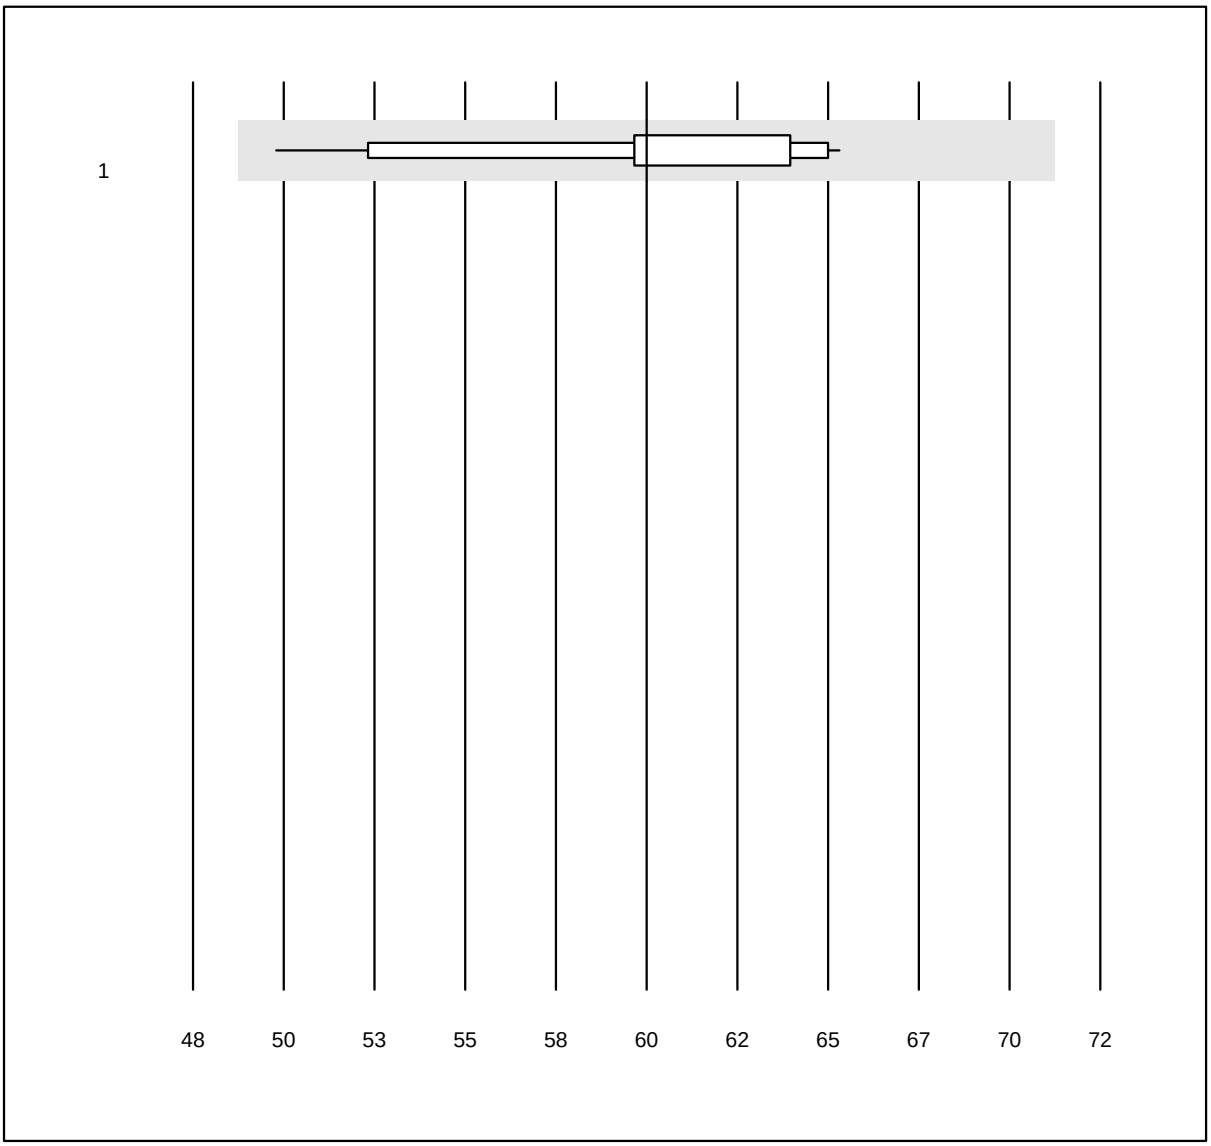


QUALAB Toleranz: 18%

Bilirubin directe (µmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	22	100.0	0.0	0.0	60	6.7	a

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Bilirubin totale Neo

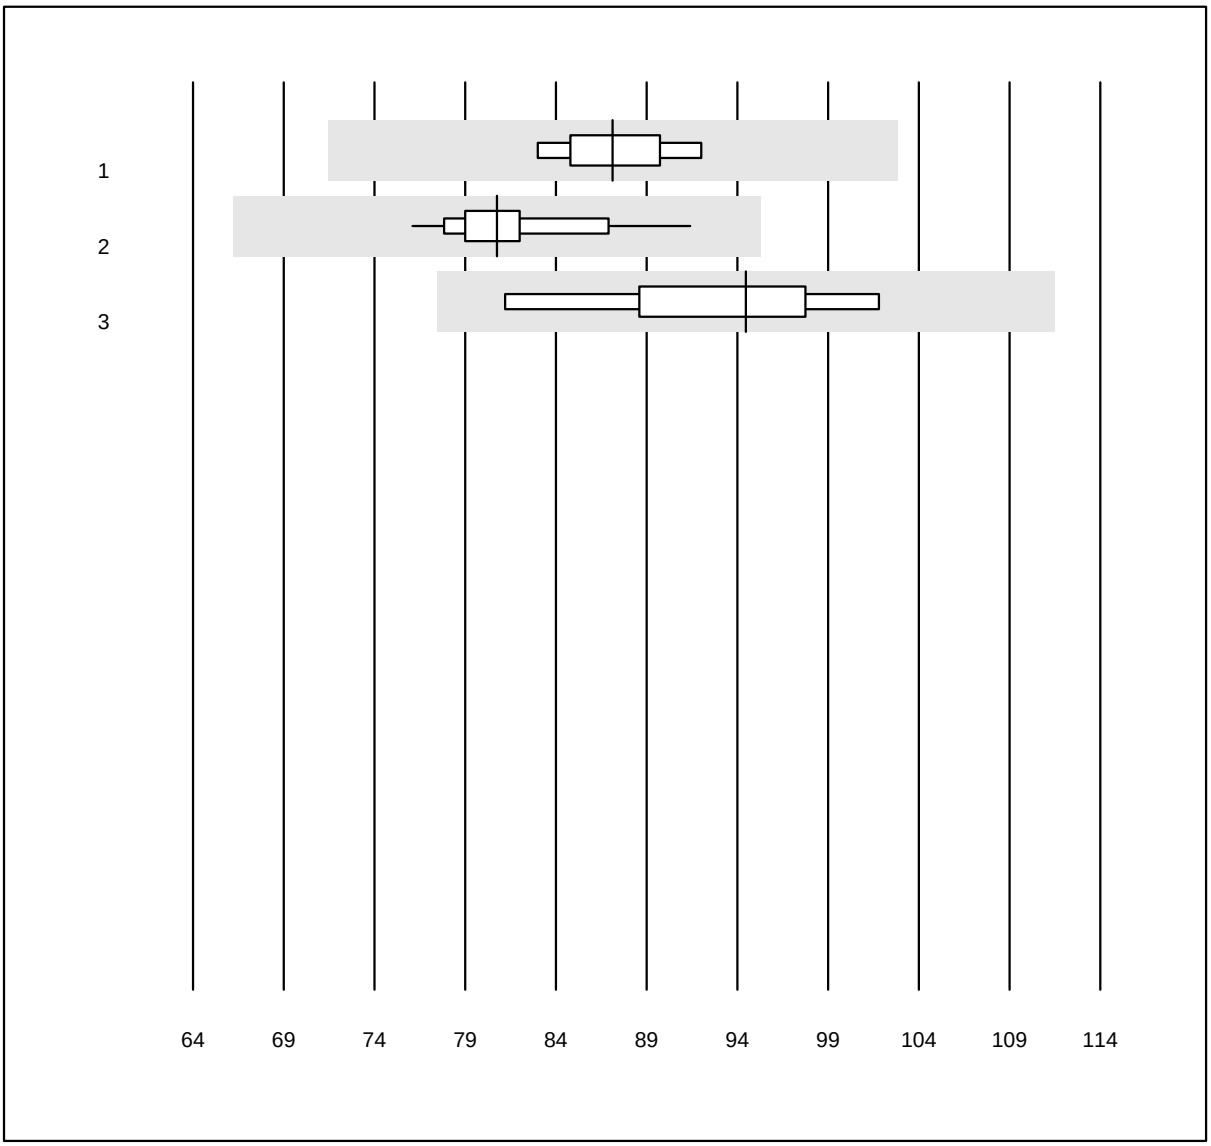


QUALAB Toleranz: 18%

Bilirubin totale Neo (µmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Autres méthodes	5	100.0	0.0	0.0	87	3.1	e
2	Roche	15	100.0	0.0	0.0	81	4.2	e
3	Siemens	9	100.0	0.0	0.0	94	6.9	e*

Bilirubin néonatale

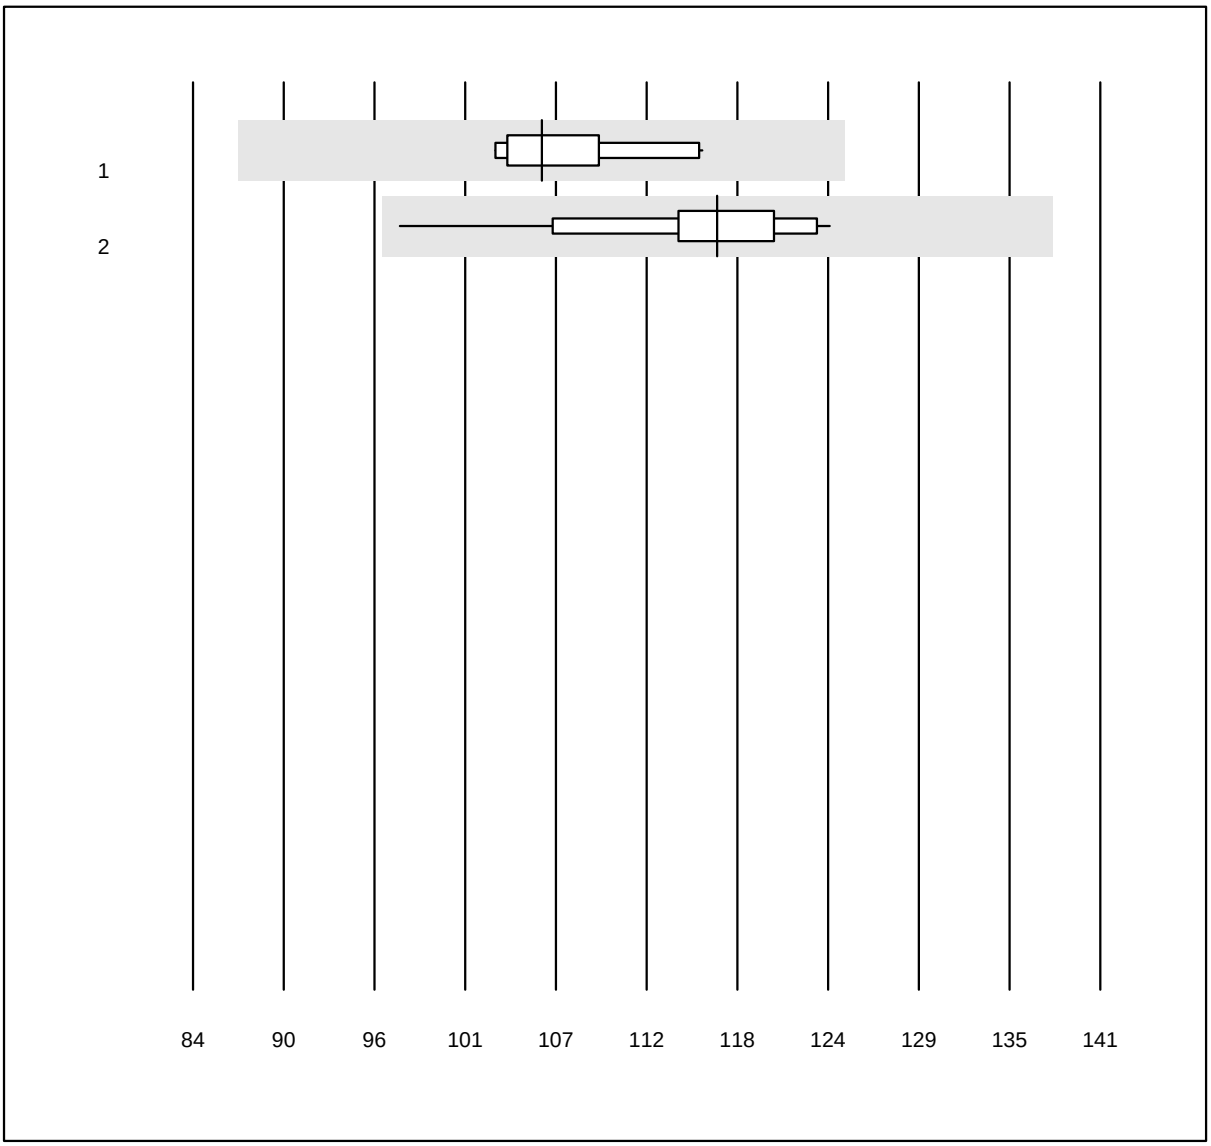


QUALAB Toleranz: 18%

Bilirubin néonatale (µmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	ABL700/800	10	100.0	0.0	0.0	106	4.4	e
2	Autres méthodes	17	100.0	0.0	0.0	117	5.6	e

AFP

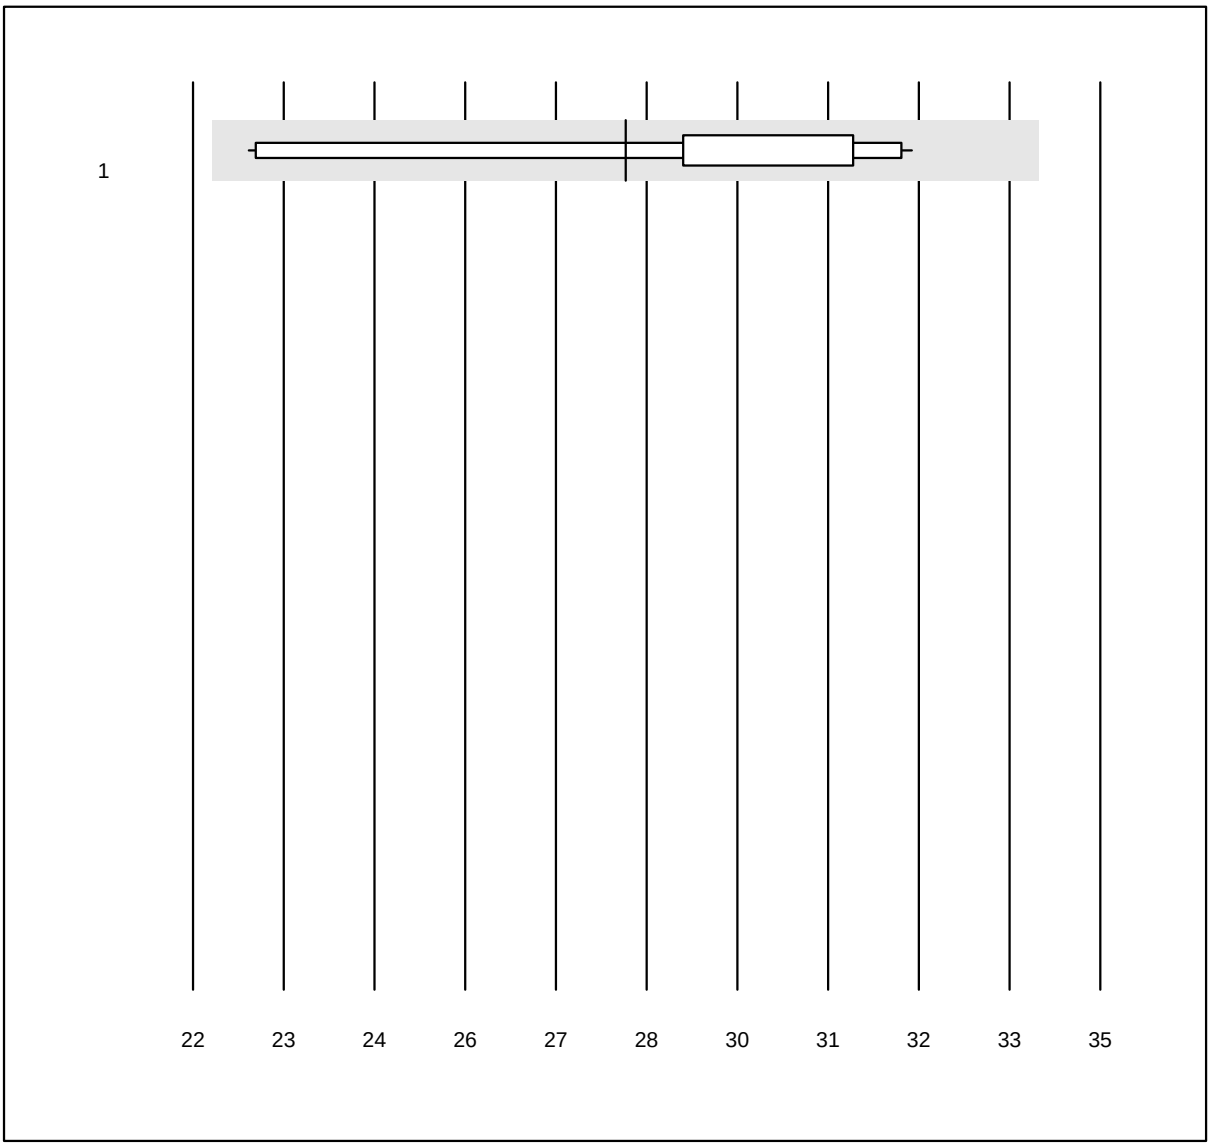


QUALAB Toleranz: 21%

AFP (µg/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	14	100.0	0.0	0.0	28.2	10.0	d*

4 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

HCG qn

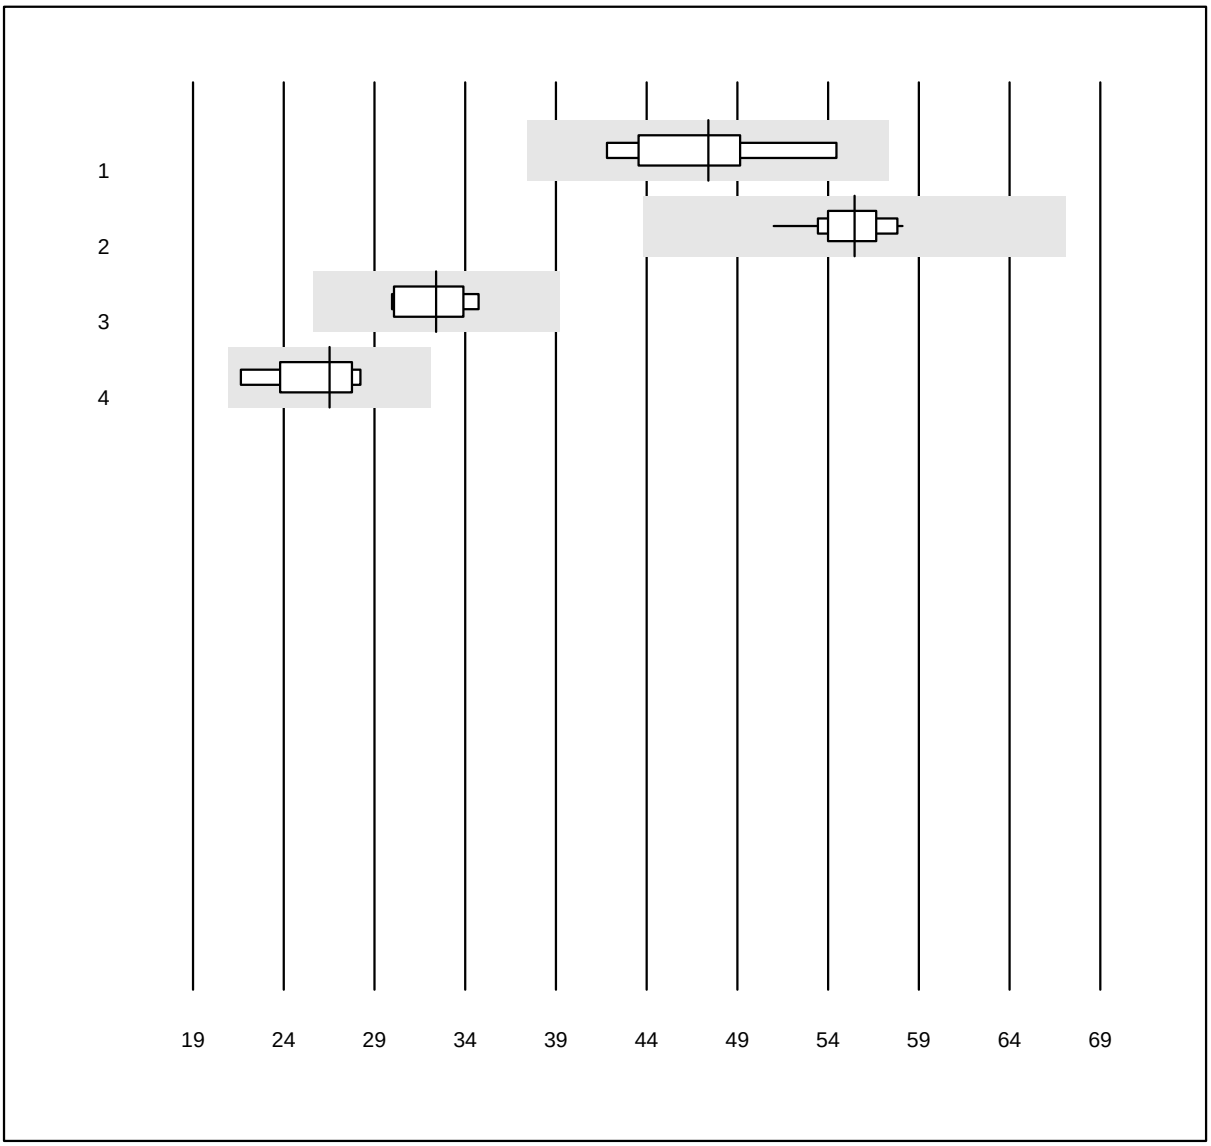


QUALAB Toleranz: 21%

HCG qn (U/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	8	100.0	0.0	0.0	47.4	8.1	e*
2	Roche	25	100.0	0.0	0.0	55.5	3.0	e
3	Siemens	6	100.0	0.0	0.0	32.4	5.9	e
4	VIDAS	5	100.0	0.0	0.0	26.5	8.6	e*

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

CA 125

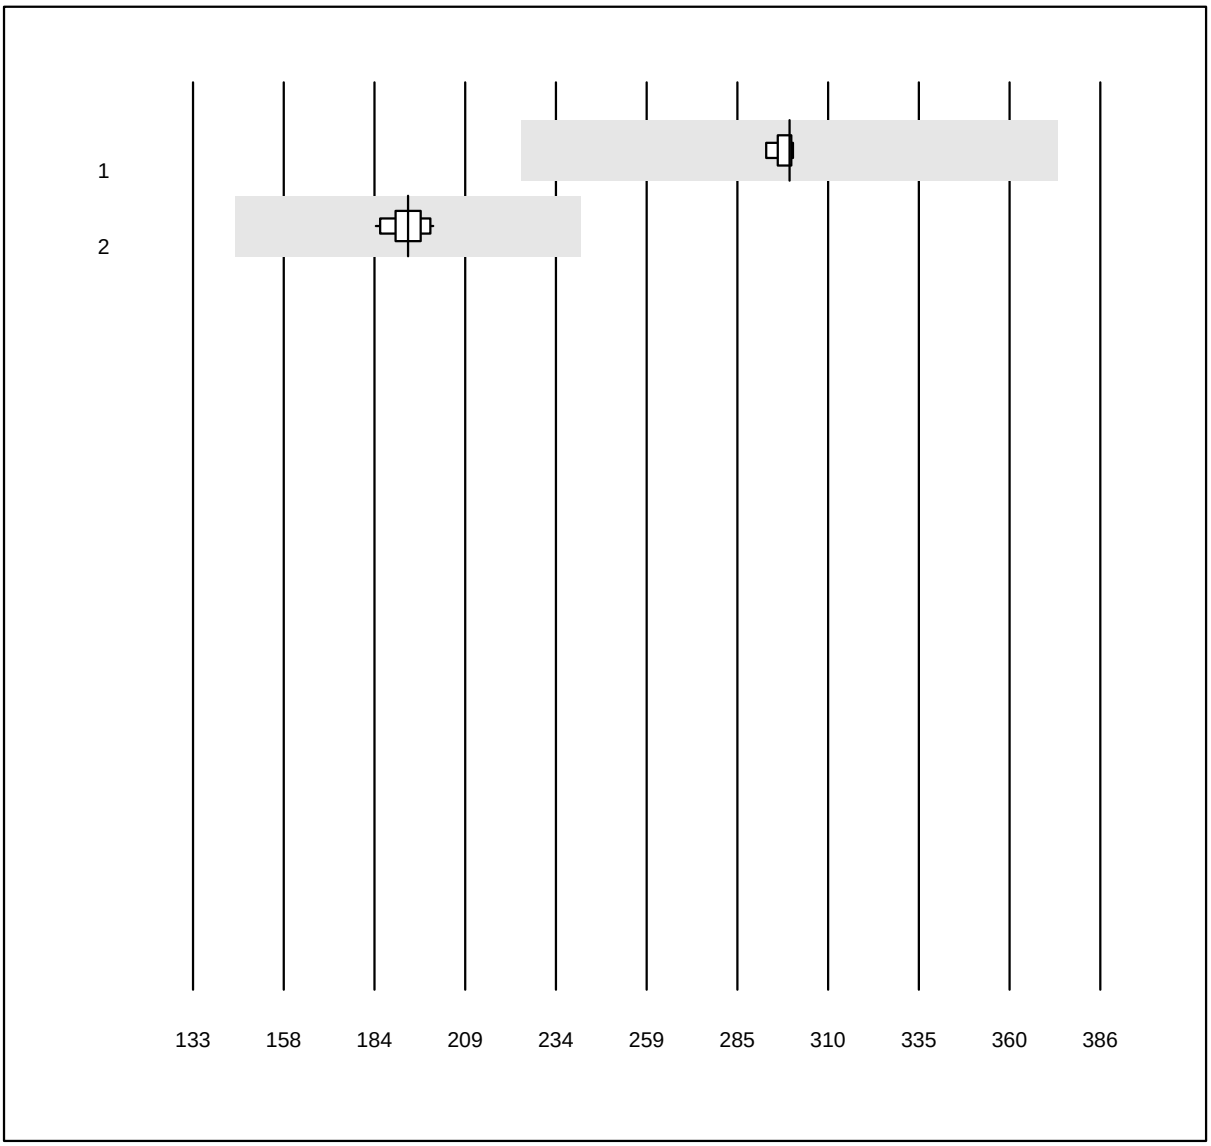


MQ Toleranz: 25%

CA 125 (kIU/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	4	100.0	0.0	0.0	299.4	0.8	e
2	Roche	13	100.0	0.0	0.0	193.0	2.4	e

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

CA 15-3

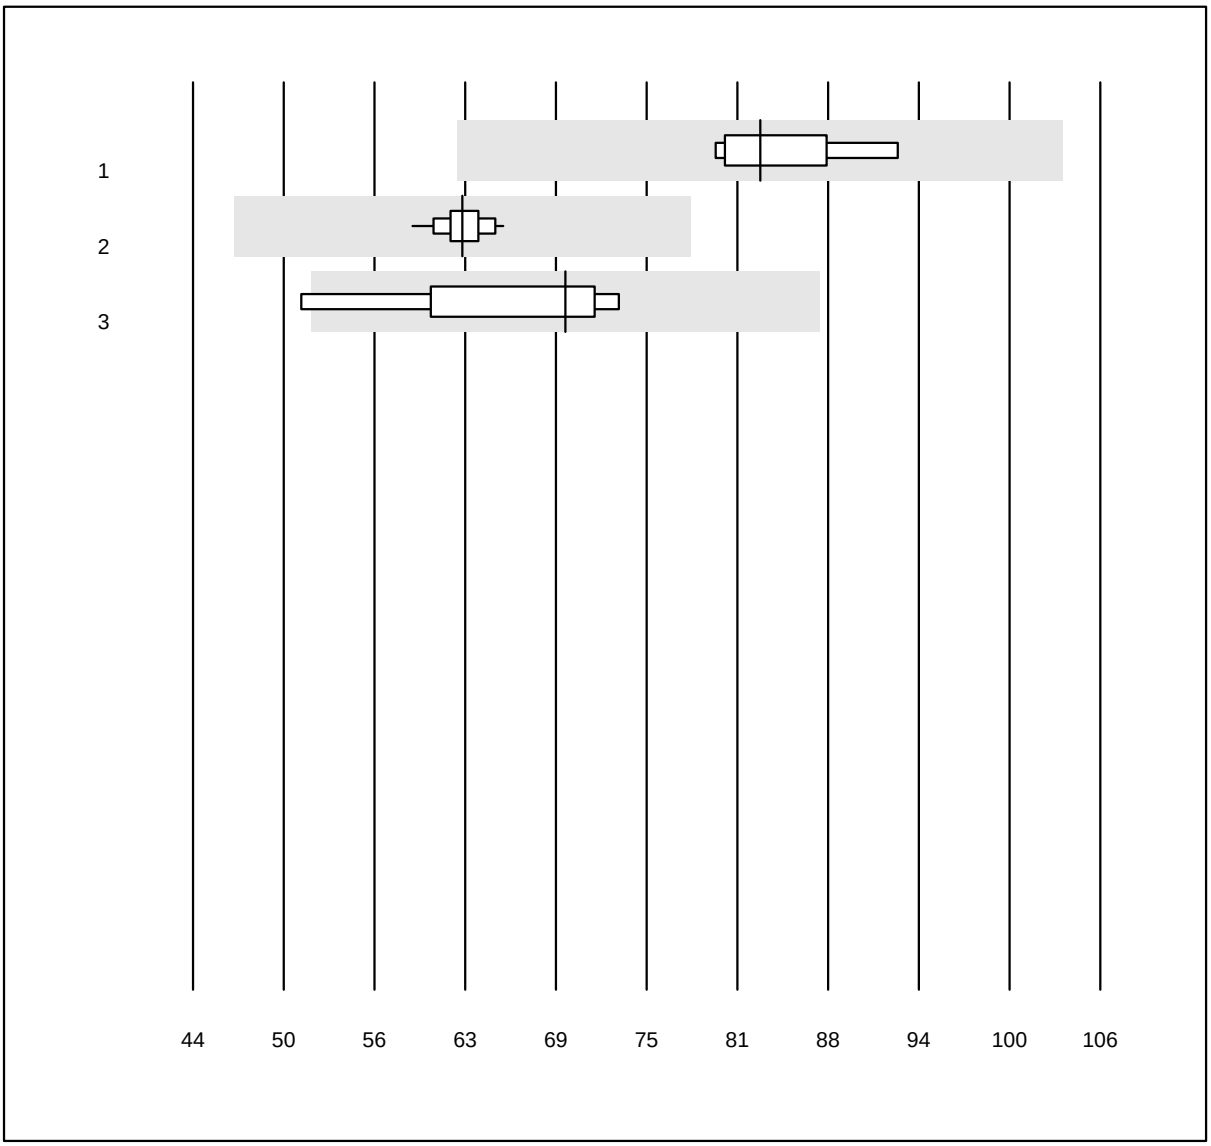


MQ Toleranz: 25%

CA 15-3 (kIU/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	5	100.0	0.0	0.0	82.8	4.8	e
2	Roche	15	100.0	0.0	0.0	62.4	2.3	e
3	Siemens	4	100.0	0.0	0.0	69.5	9.9	e*

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

CA 19-9

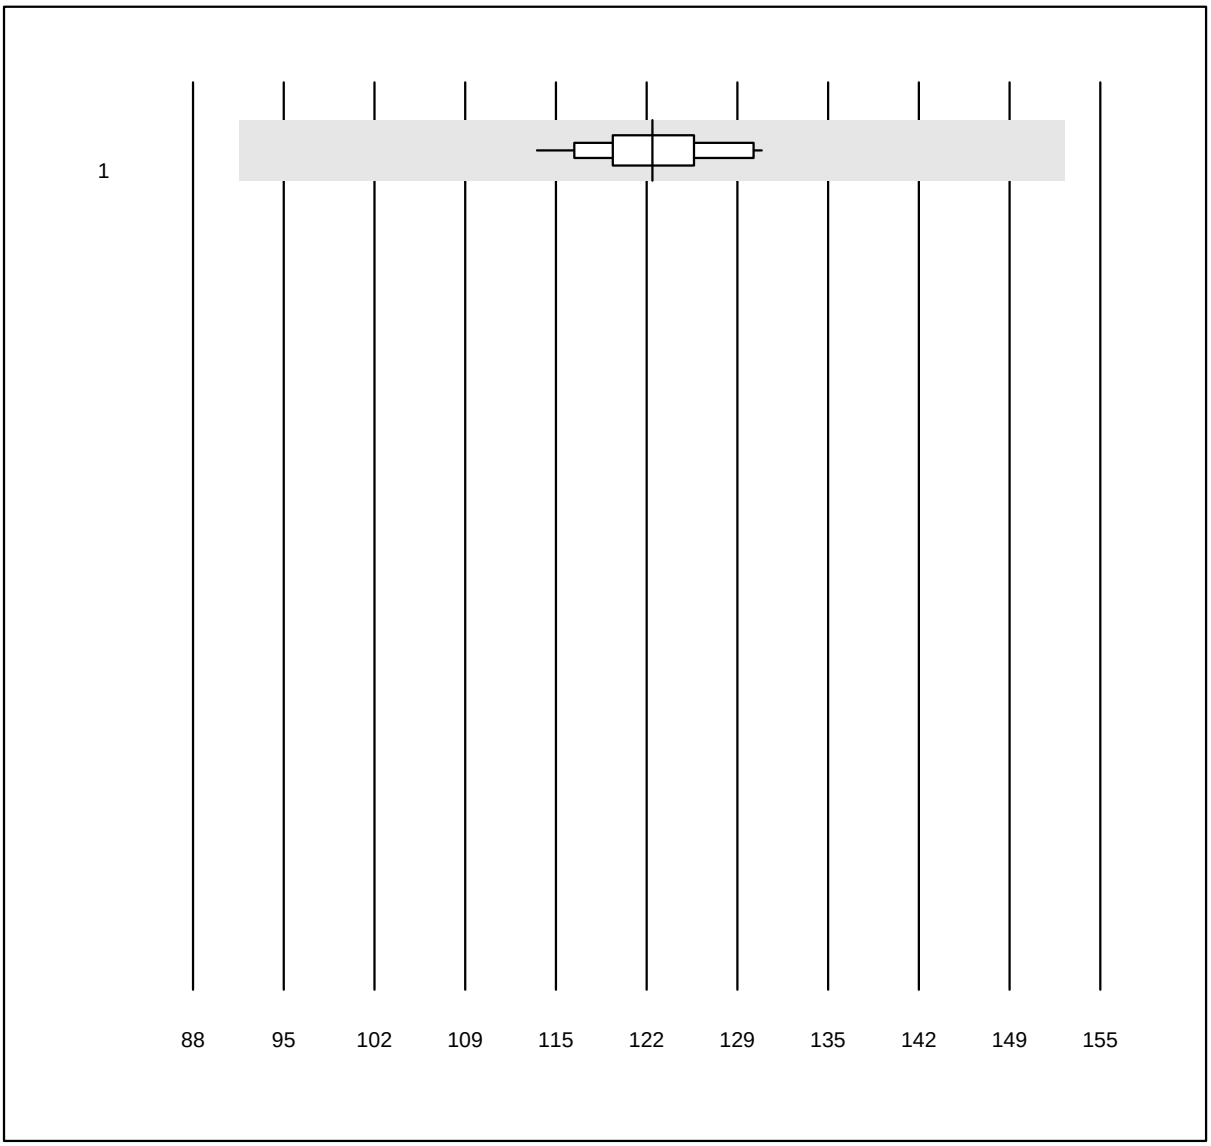


MQ Toleranz: 25%

CA 19-9 (kIU/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	15	100.0	0.0	0.0	121.9	3.5	e

4 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

CEA

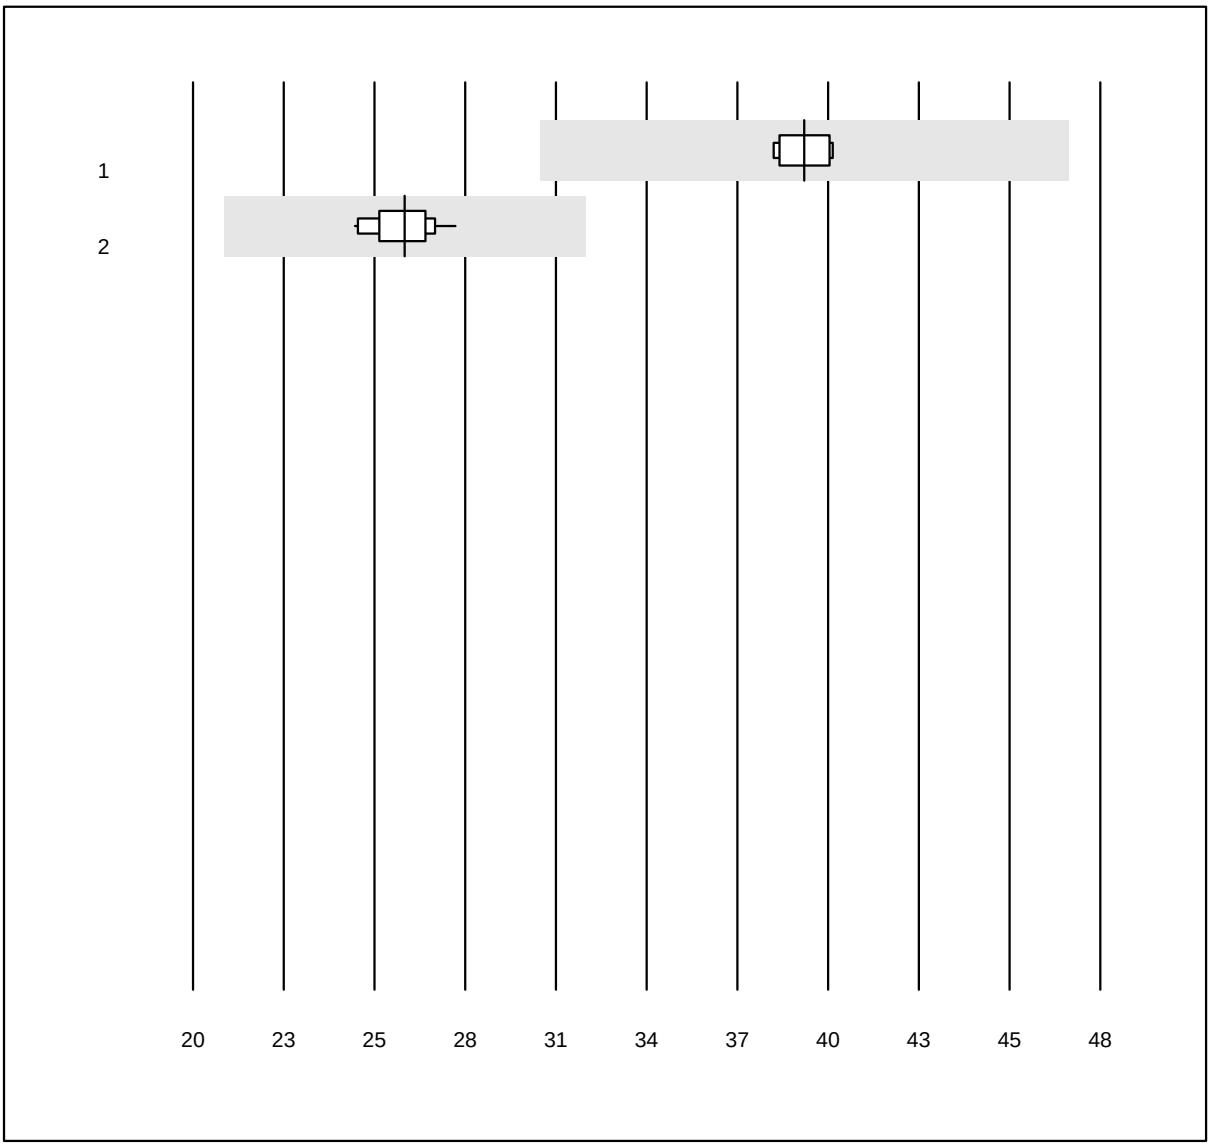


QUALAB Toleranz: 21%

CEA (µg/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	5	100.0	0.0	0.0	38.9	2.0	e
2	Roche	18	100.0	0.0	0.0	26.5	3.3	e

3 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

HCG intakt

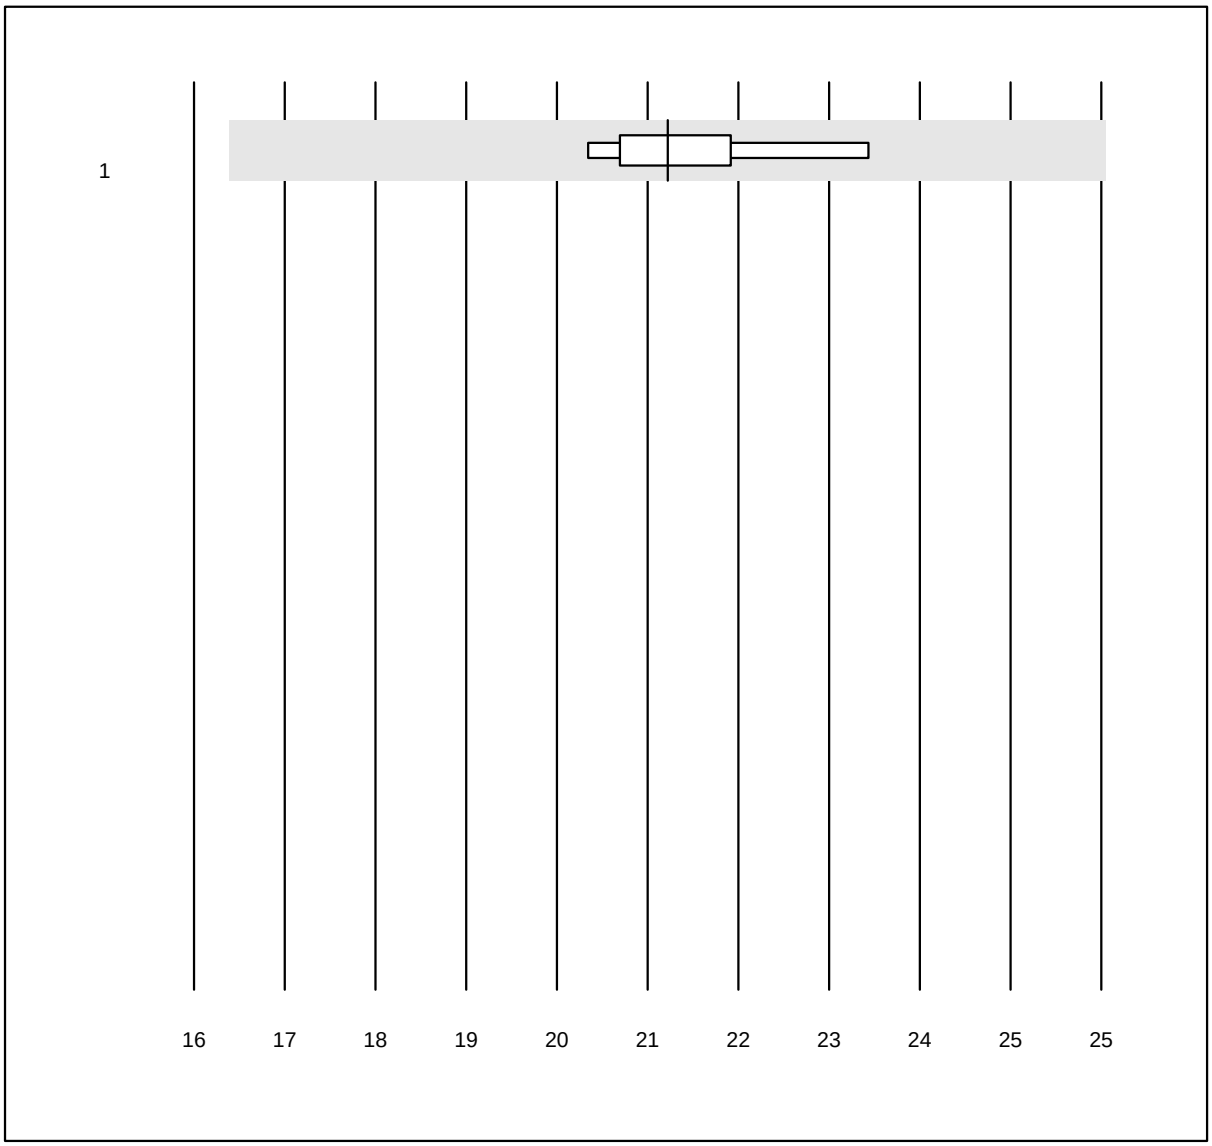


QUALAB Toleranz: 21%

HCG intakt (U/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Cobas	6	100.0	0.0	0.0	20.7	3.9	e

NSE

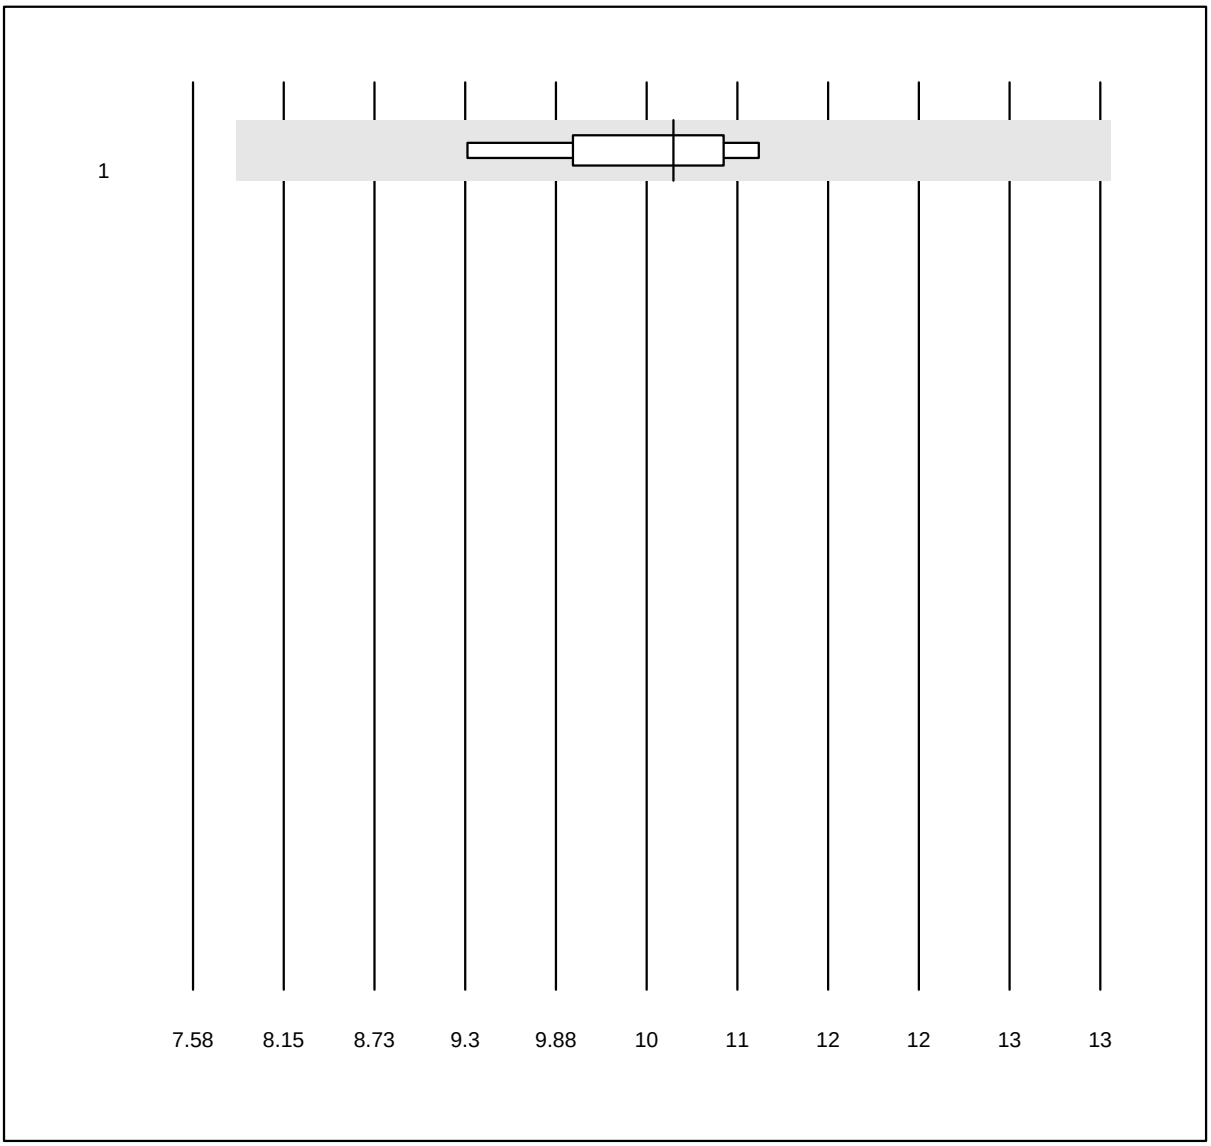


MQ Toleranz: 25%

NSE (ng/ml)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	6	100.0	0.0	0.0	10.4	5.3	e

PSA

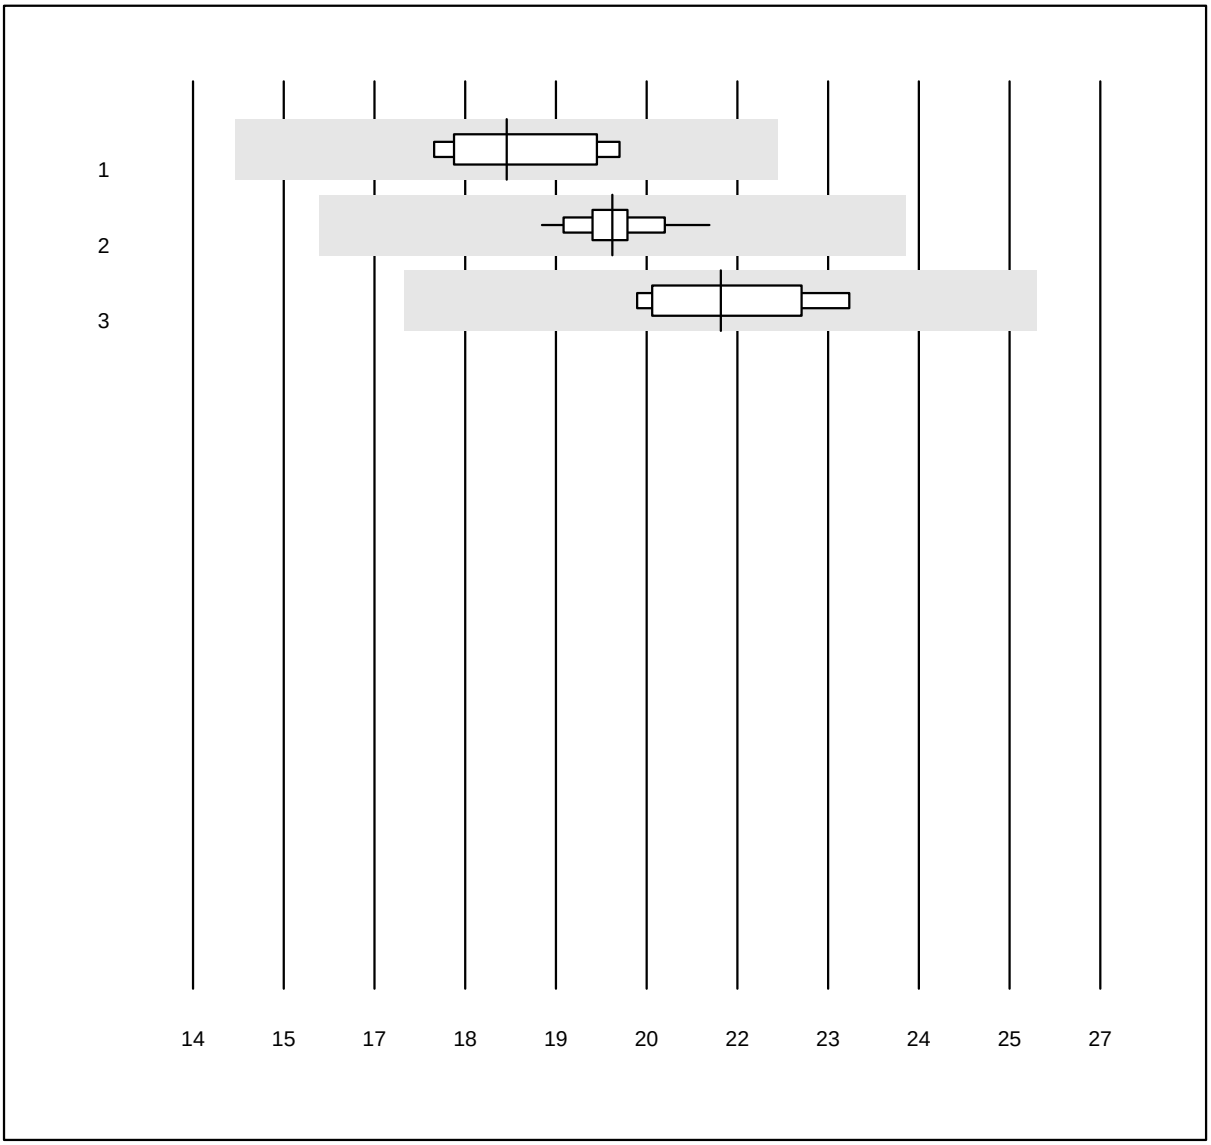


QUALAB Toleranz: 21%

PSA (µg/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	8	100.0	0.0	0.0	18.50	5.3	e
2	Roche	26	100.0	0.0	0.0	20.01	2.6	e
3	AFIAS	5	100.0	0.0	0.0	21.56	5.1	e

3 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

PSA frei

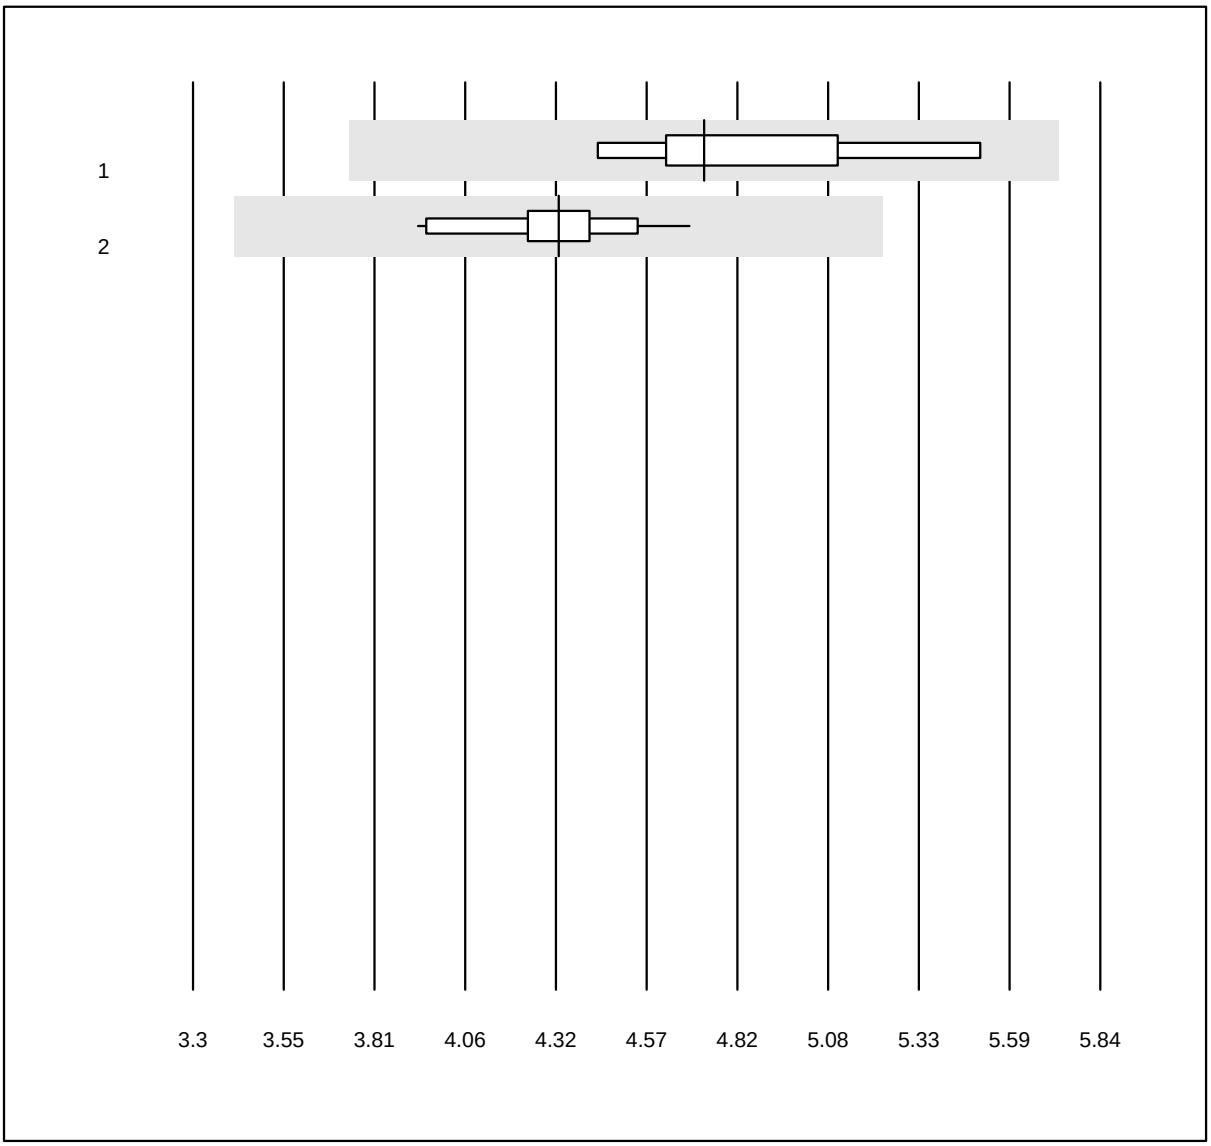


QUALAB Toleranz: 21%

PSA frei (µg/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	6	100.0	0.0	0.0	4.73	6.6	e*
2	Roche	20	100.0	0.0	0.0	4.32	4.4	e

3 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

S100

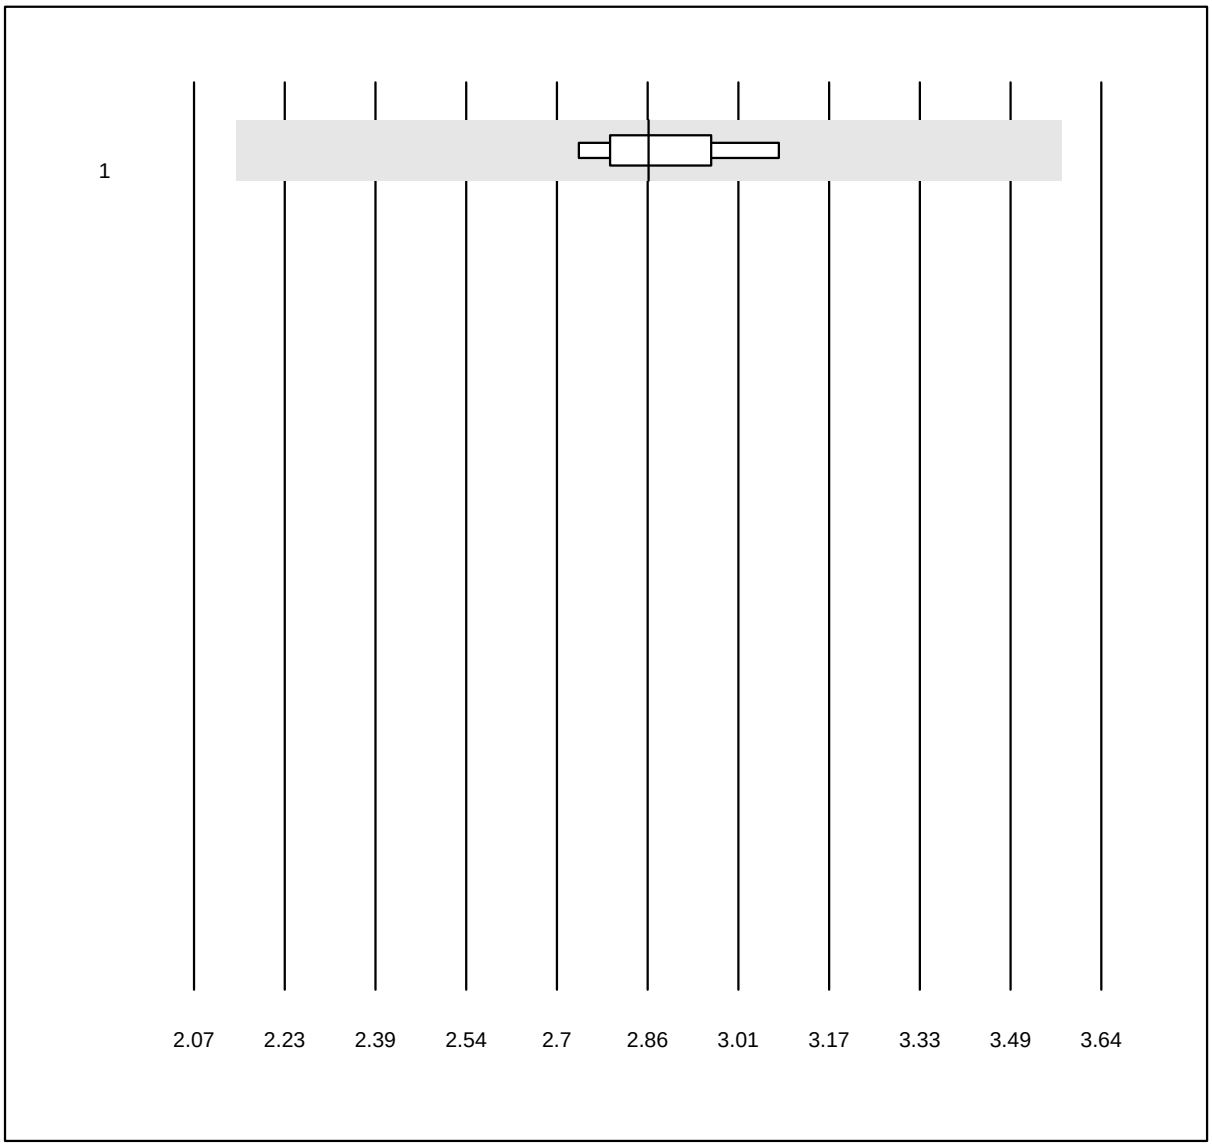


MQ Toleranz: 25%

S100 (µg/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	5	100.0	0.0	0.0	2.86	3.5	e

Thyreoglobuline

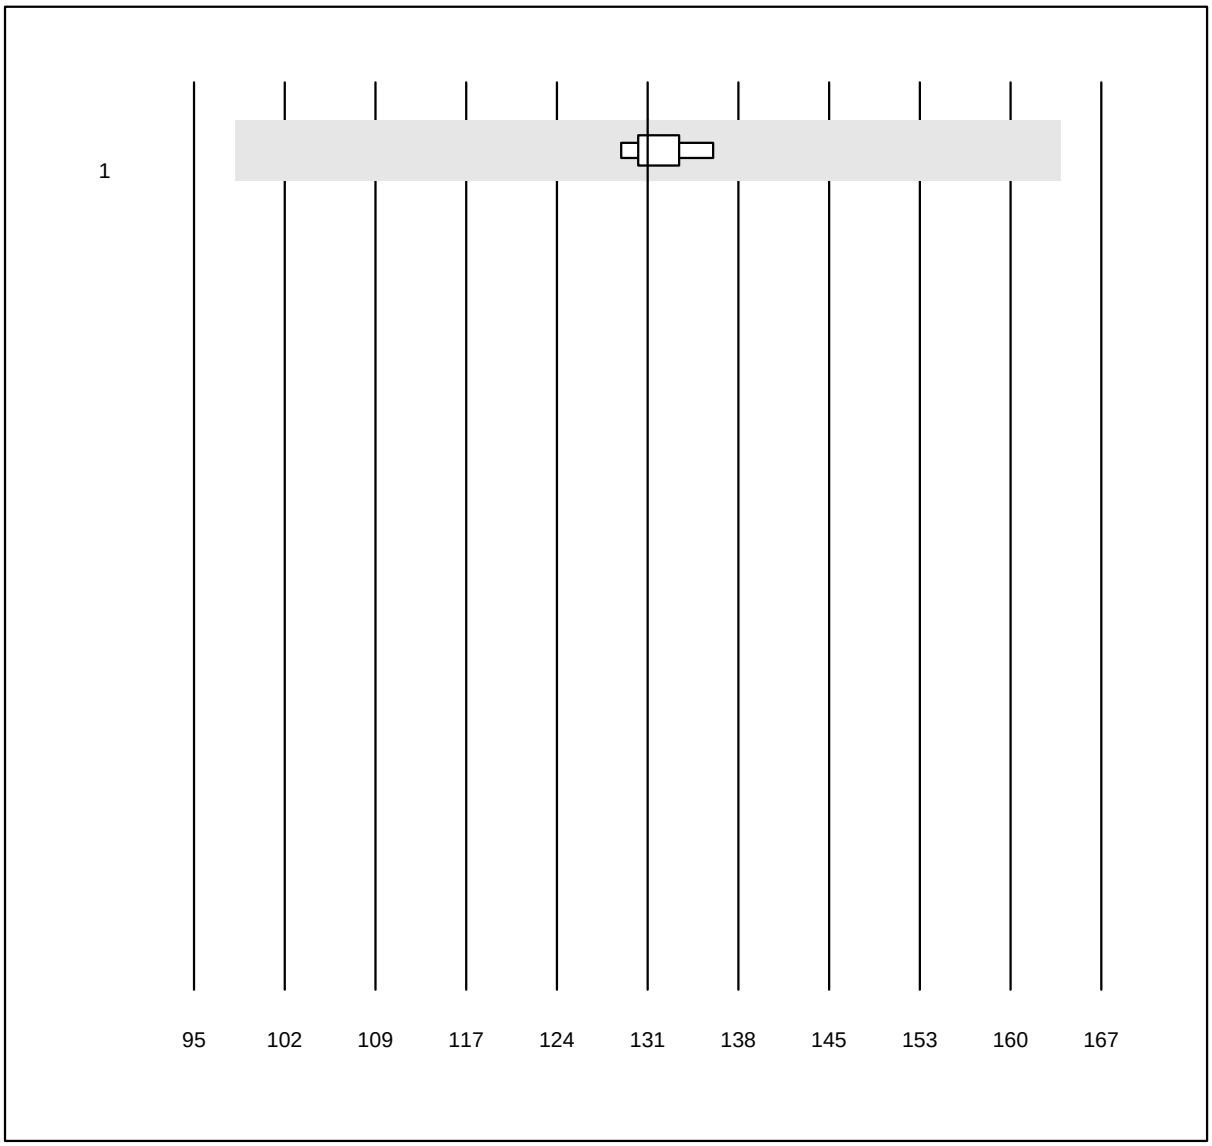


MQ Toleranz: 25%

Thyreoglobuline (µg/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	8	100.0	0.0	0.0	131.0	1.7	e

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

CK-MB

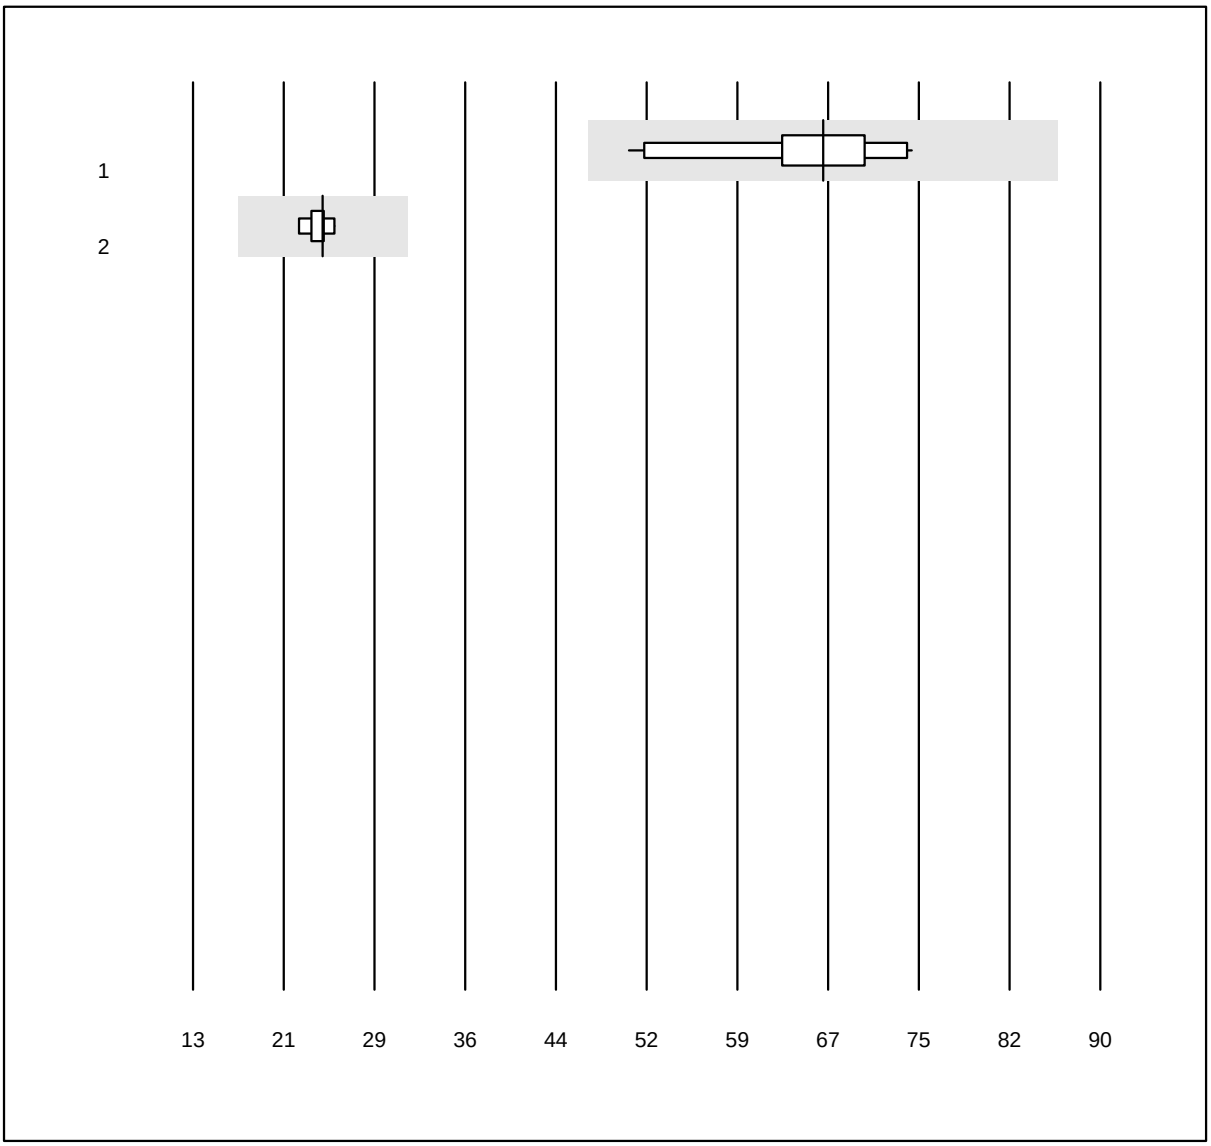


MQ Toleranz: 30%

CK-MB (U/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Fuji Dri-Chem	10	100.0	0.0	0.0	66.5	10.0	e
2	Cobas/Roche	9	100.0	0.0	0.0	24.0	3.9	e

ACTH

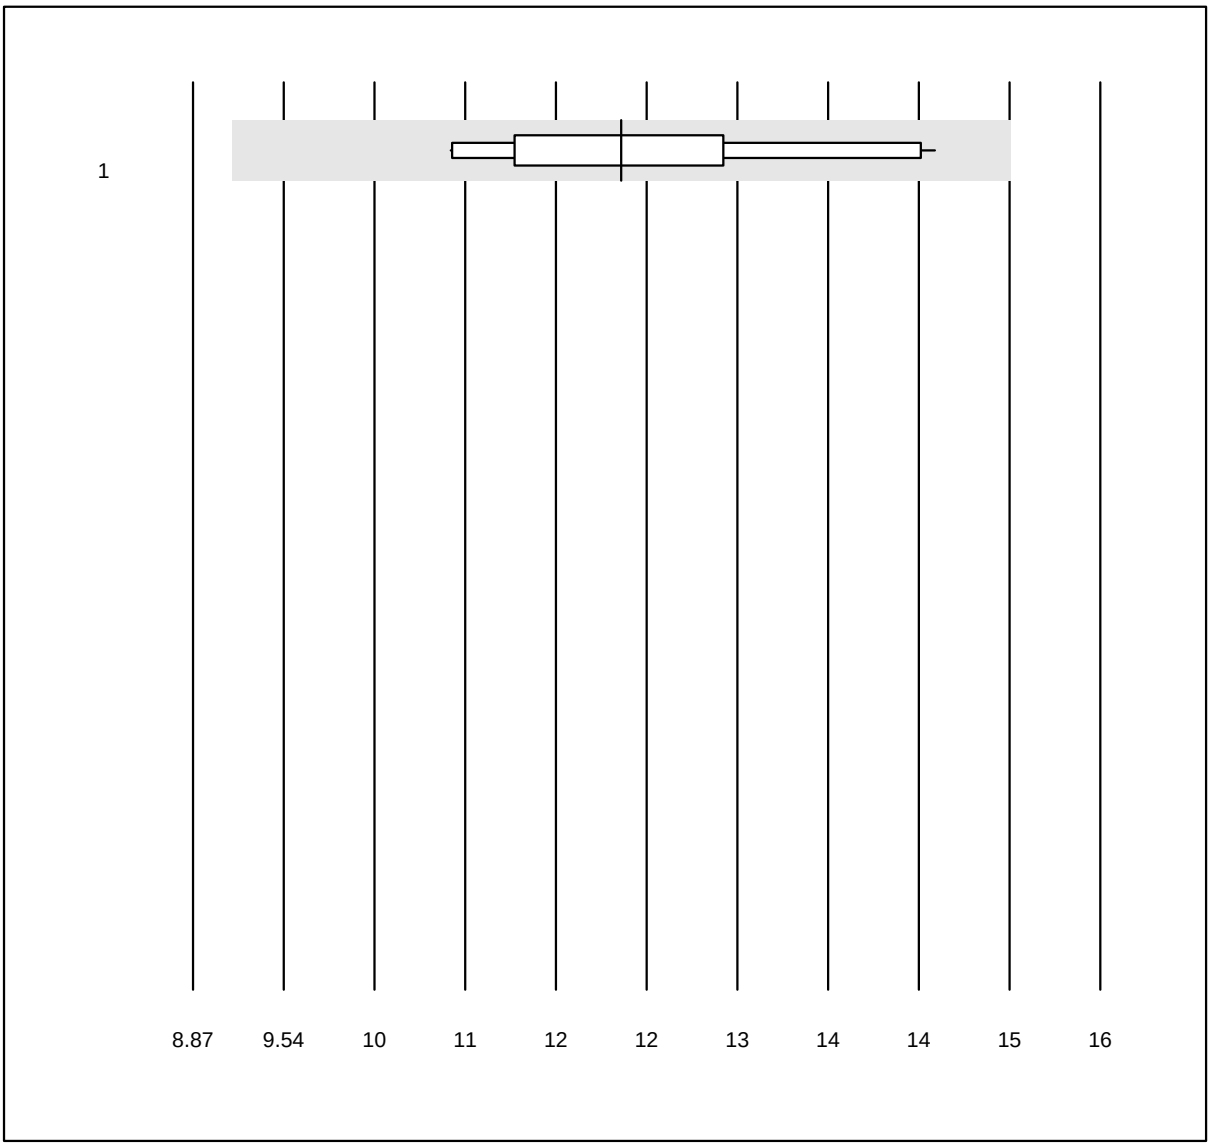


MQ Toleranz: 25%

ACTH (ng/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	10	100.0	0.0	0.0	12.24	9.6	e*

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

C-Peptid

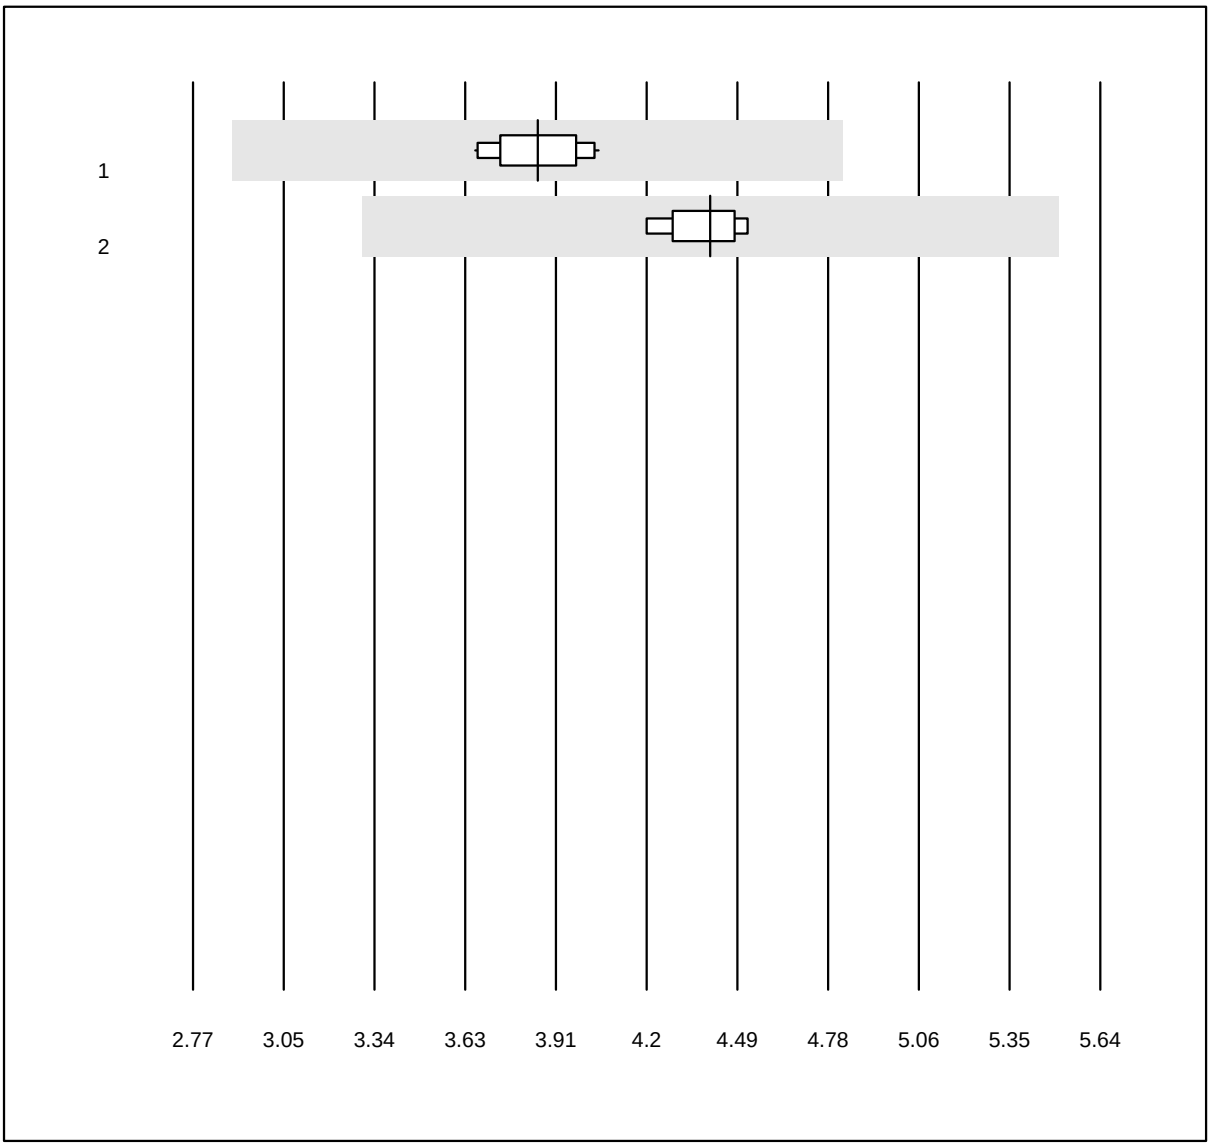


MQ Toleranz: 25%

C-Peptid (nmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	11	100.0	0.0	0.0	3.86	3.3	e
2	Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	4.41	2.3	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Procalcitonine

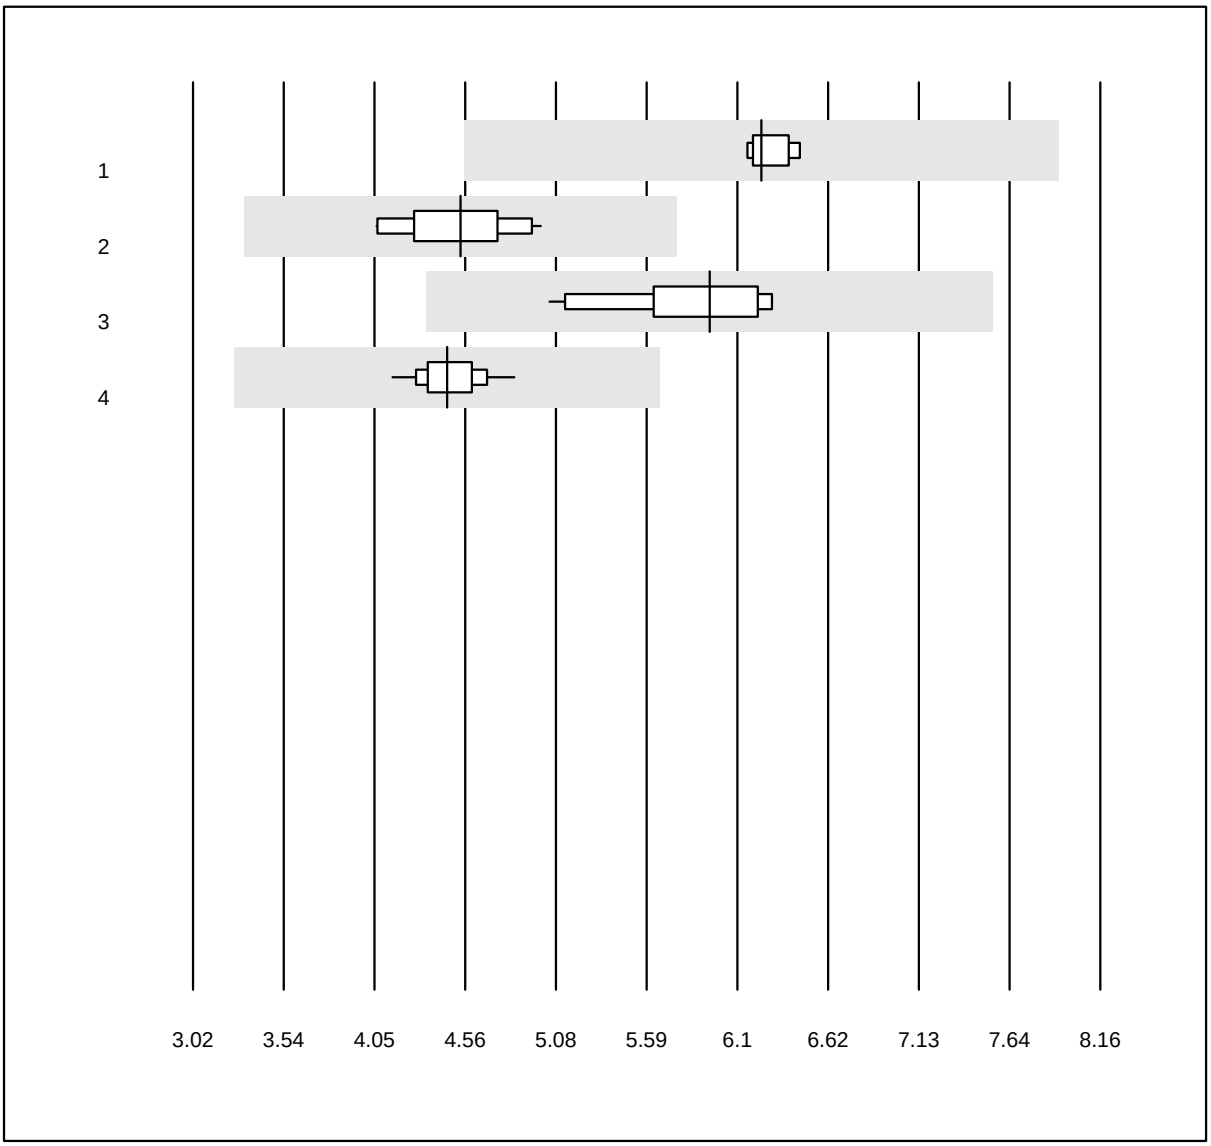


QUALAB Toleranz: 27%

Procalcitonine (µg/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	6	100.0	0.0	0.0	6.24	1.7	e
2	VIDAS	14	100.0	0.0	0.0	4.54	6.7	e
3	Siemens	11	100.0	0.0	0.0	5.95	6.6	e
4	Roche	23	100.0	0.0	0.0	4.46	3.6	e

3 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Parathormone

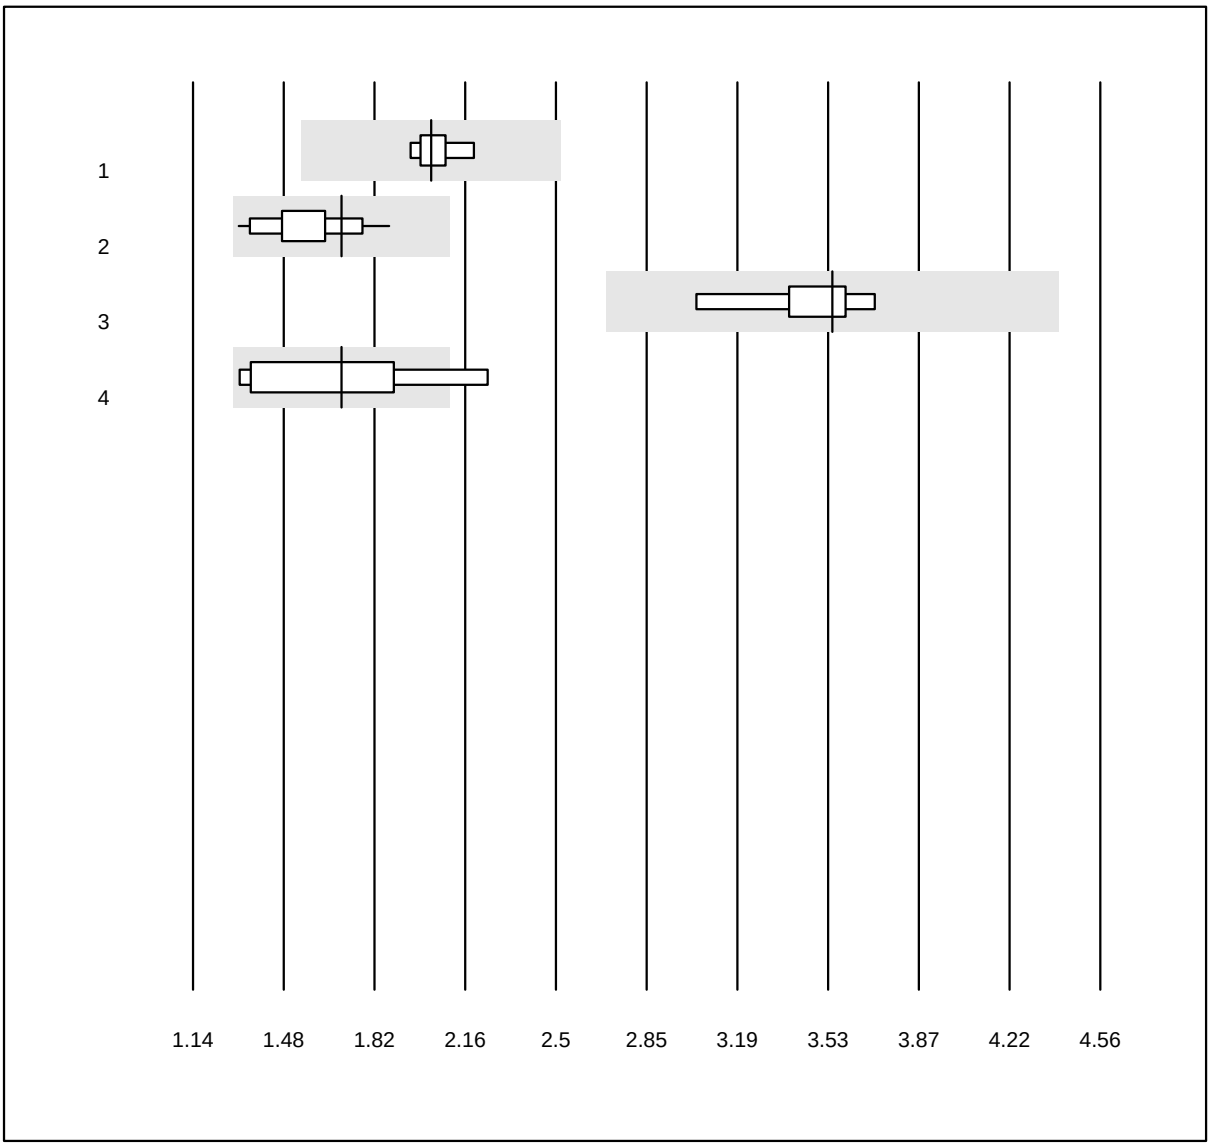


QUALAB Toleranz: 24%

Parathormone (pmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Cobas	8	100.0	0.0	0.0	2.0	3.5	e
2	Cobas PTH STAT	17	100.0	0.0	0.0	1.7	9.3	a
3	ADVIA Centaur XP/CP	8	100.0	0.0	0.0	3.5	5.7	e
4	Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	1.7	19.3	a*

6 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)


Glukose-K22

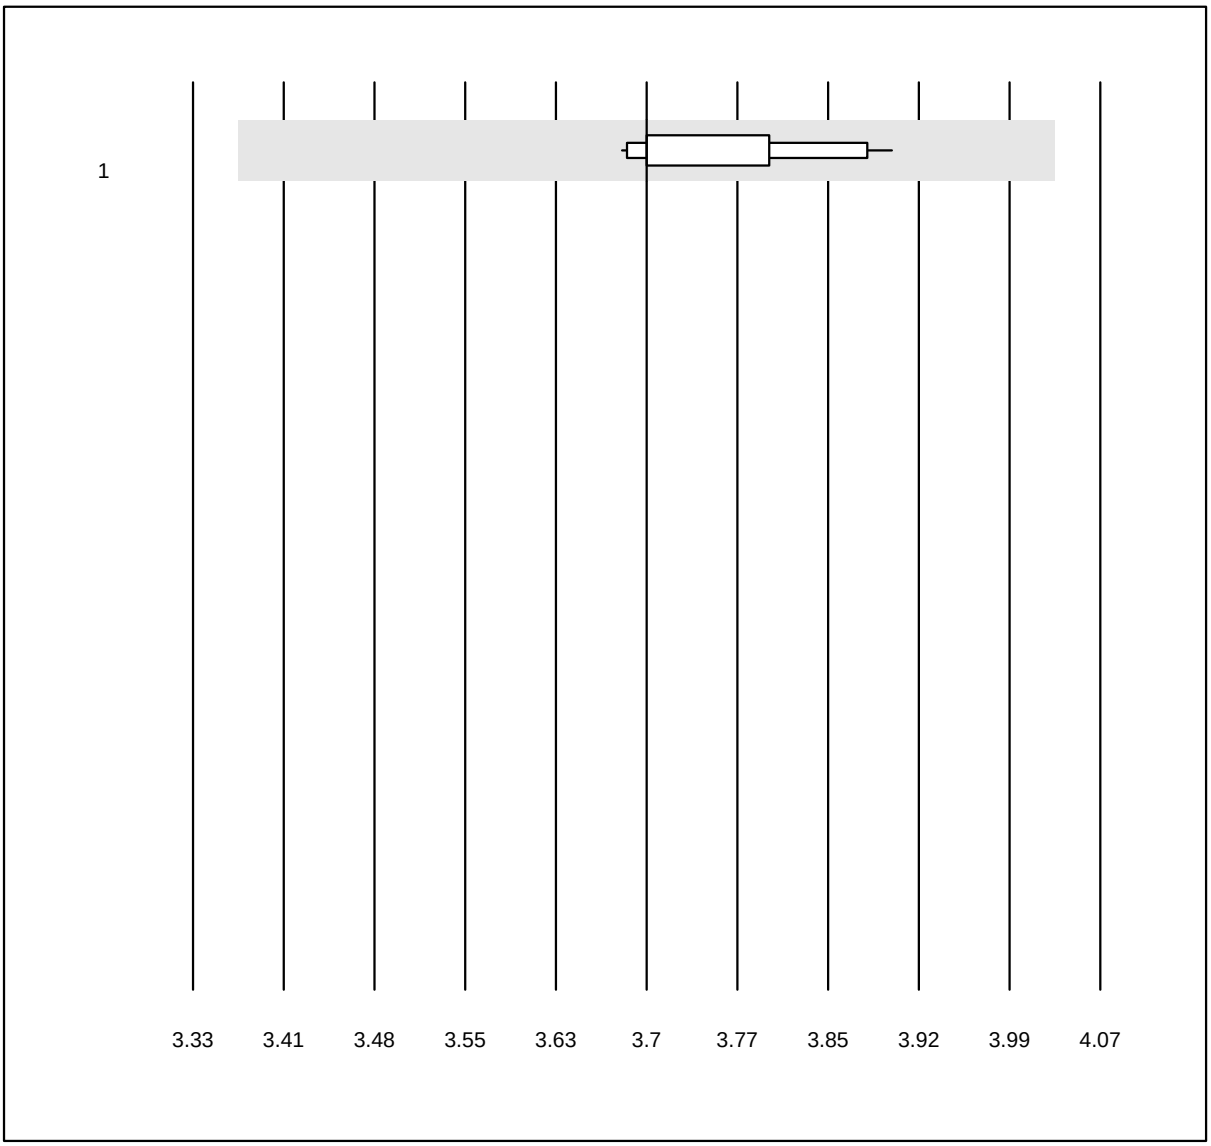

QUALAB Toleranz: 9% Glukose-K22 (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Chimie humide	13	84.6	0.0	15.4	3.7	1.8	e

Harnstoff-K22

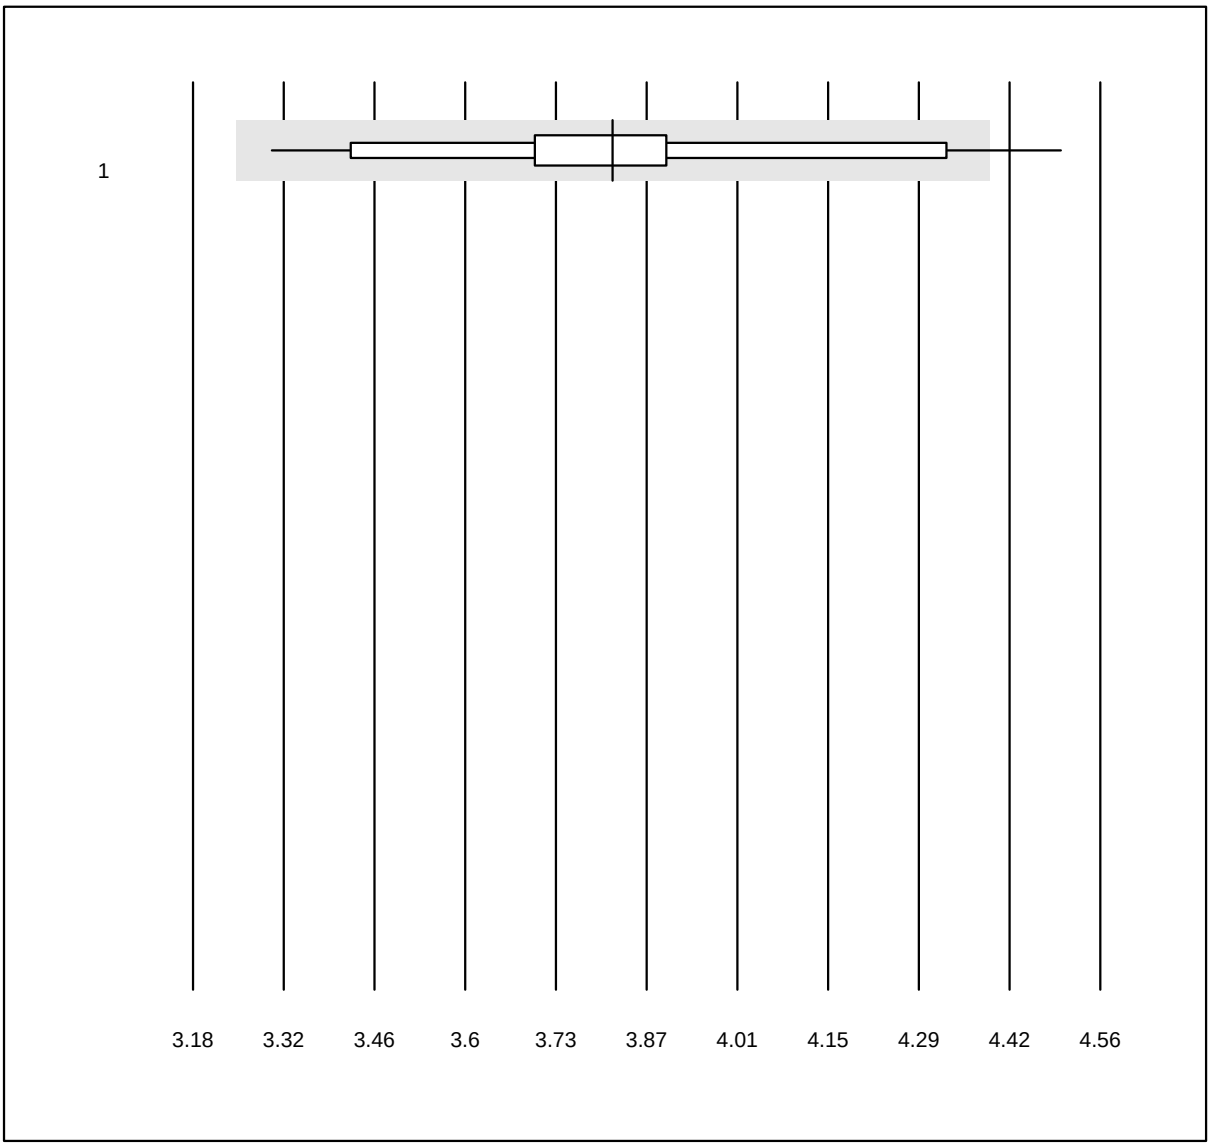


QUALAB Toleranz: 15%

Harnstoff-K22 (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Chimie humide	13	84.6	7.7	7.7	3.8	7.1	e*

Kalium-K22

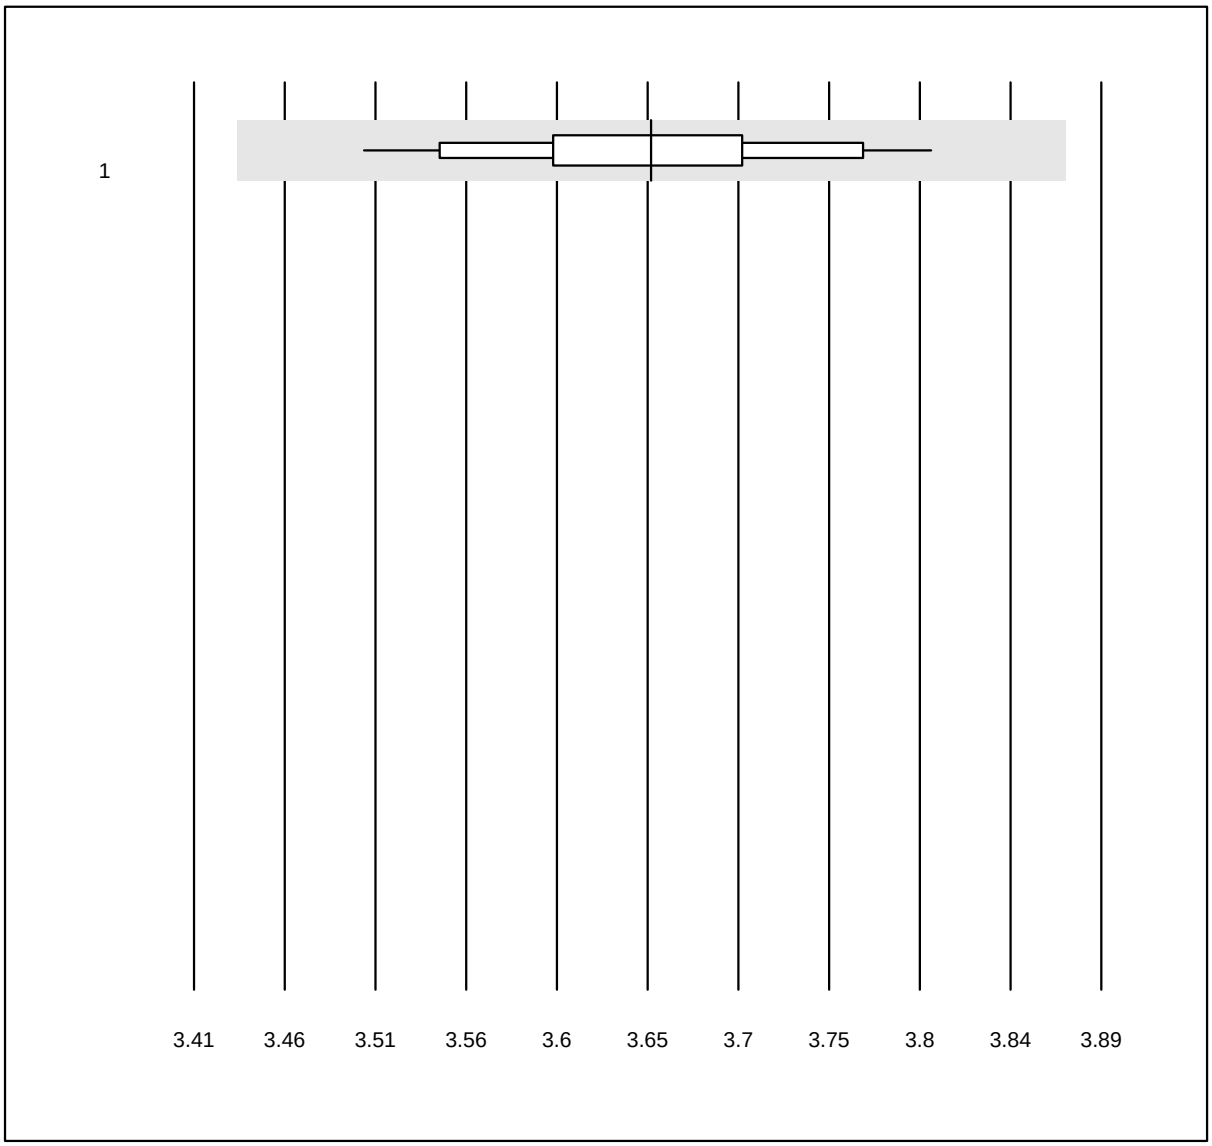


QUALAB Toleranz: 6%

Kalium-K22 (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	ISE	13	100.0	0.0	0.0	3.7	2.1	e

Natrium-K22

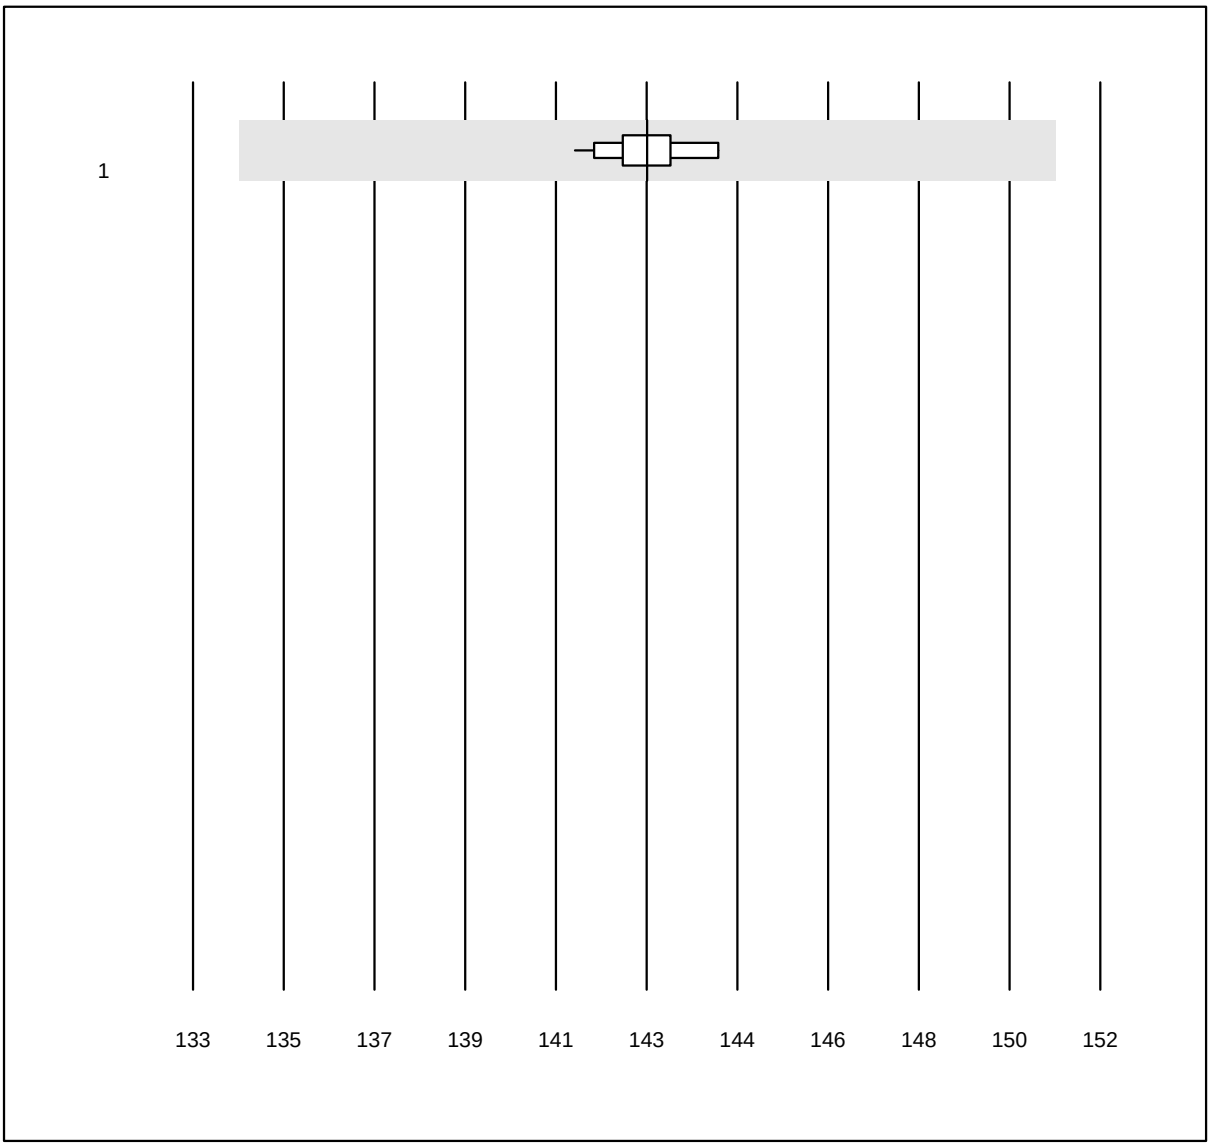


QUALAB Toleranz: 6%

Natrium-K22 (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	ISE	13	100.0	0.0	0.0	143	0.6	e

Osmolalité

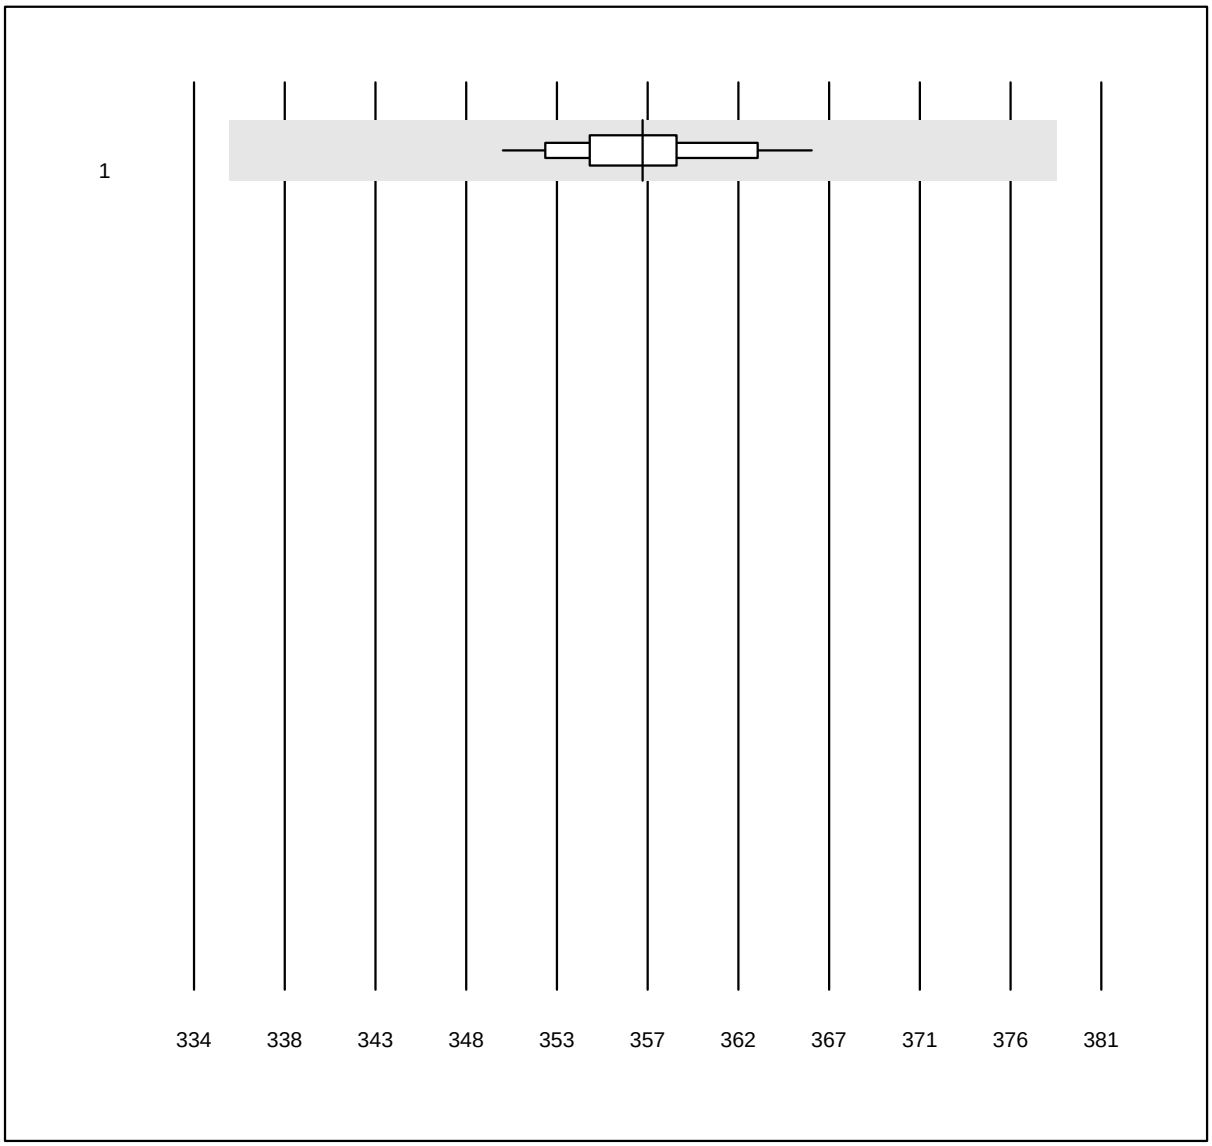


QUALAB Toleranz: 6%

Osmolalité (mosm/kg)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Cryoscopie	25	100.0	0.0	0.0	357	1.1	e

Osmotische Lücke

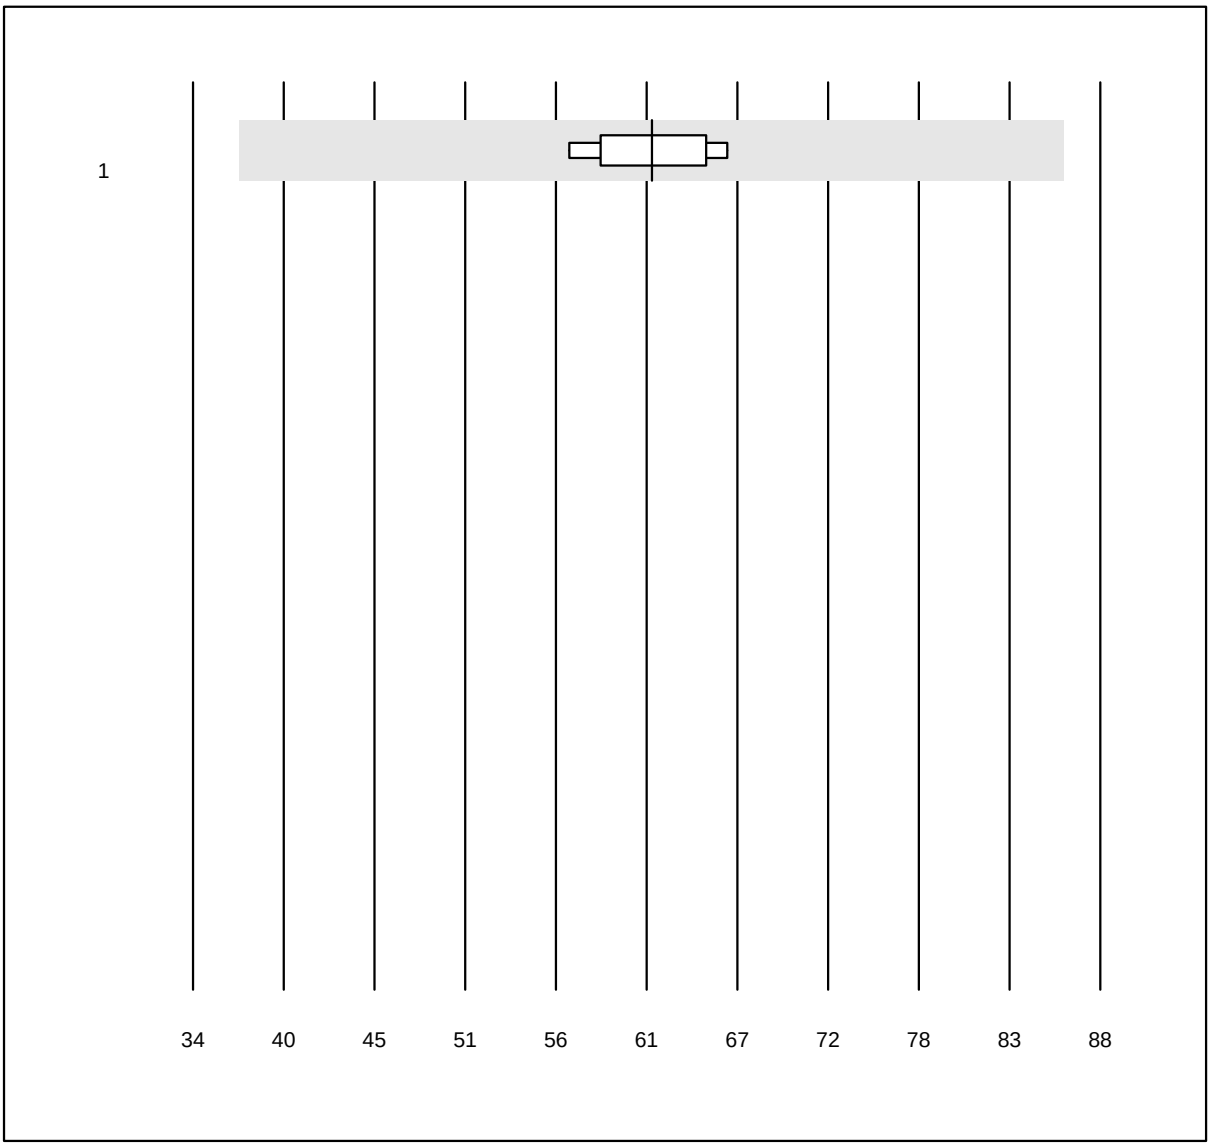


MQ Toleranz: 40%

Osmotische Lücke (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Formule 1 (2Na+K+Glu+Hst)	9	100.0	0.0	0.0	61.3	5.6	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Digoxin

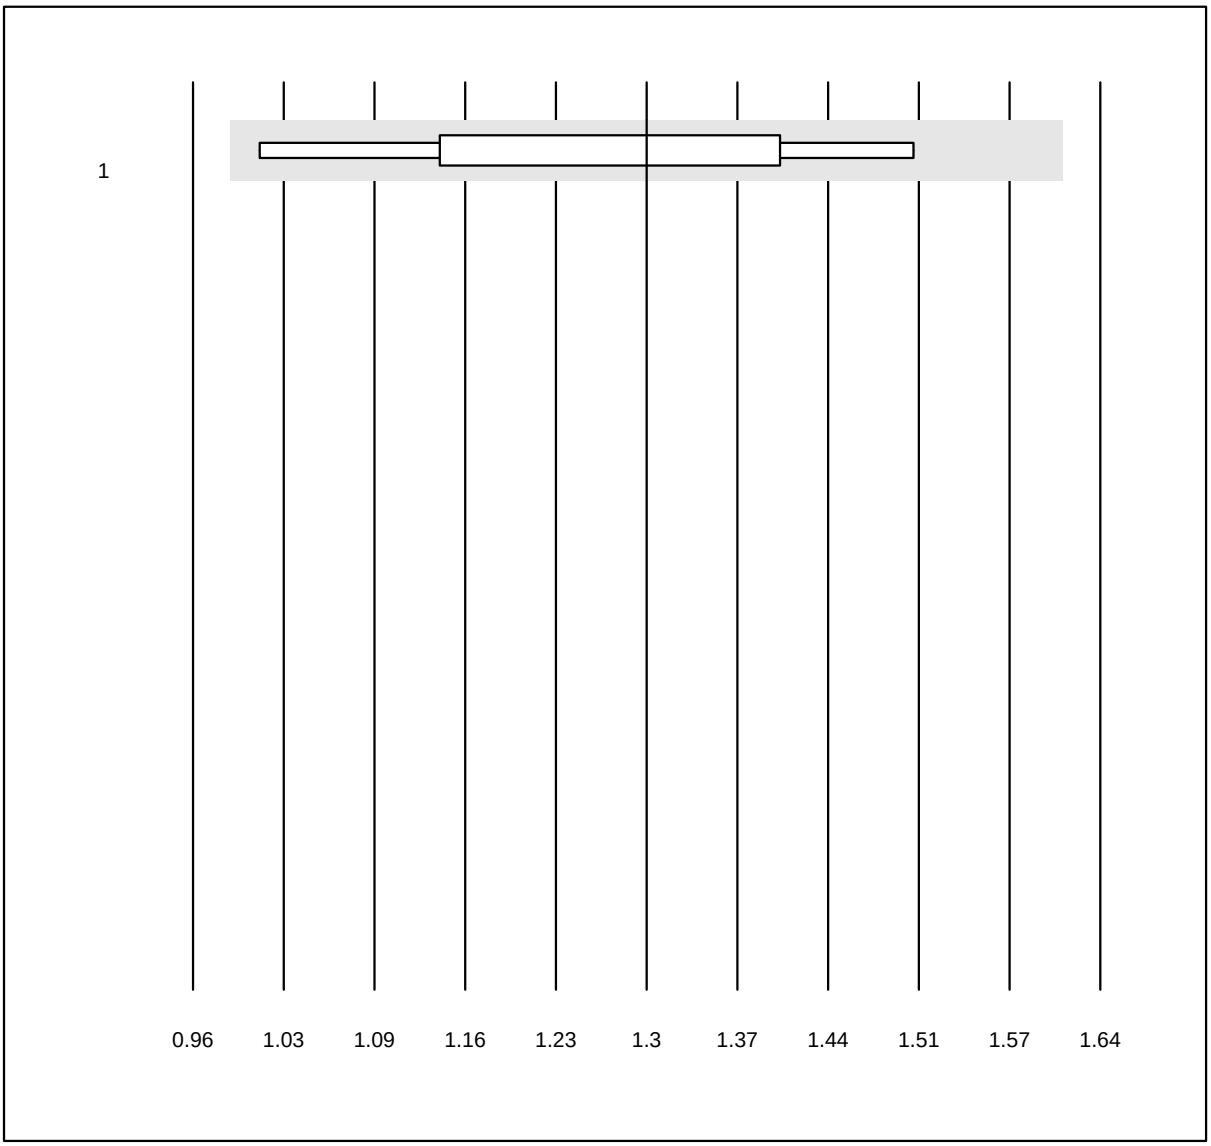


QUALAB Toleranz: 24%

Digoxin (nmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Autres méthodes	9	100.0	0.0	0.0	1.30	12.9	e*

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Paracetamol

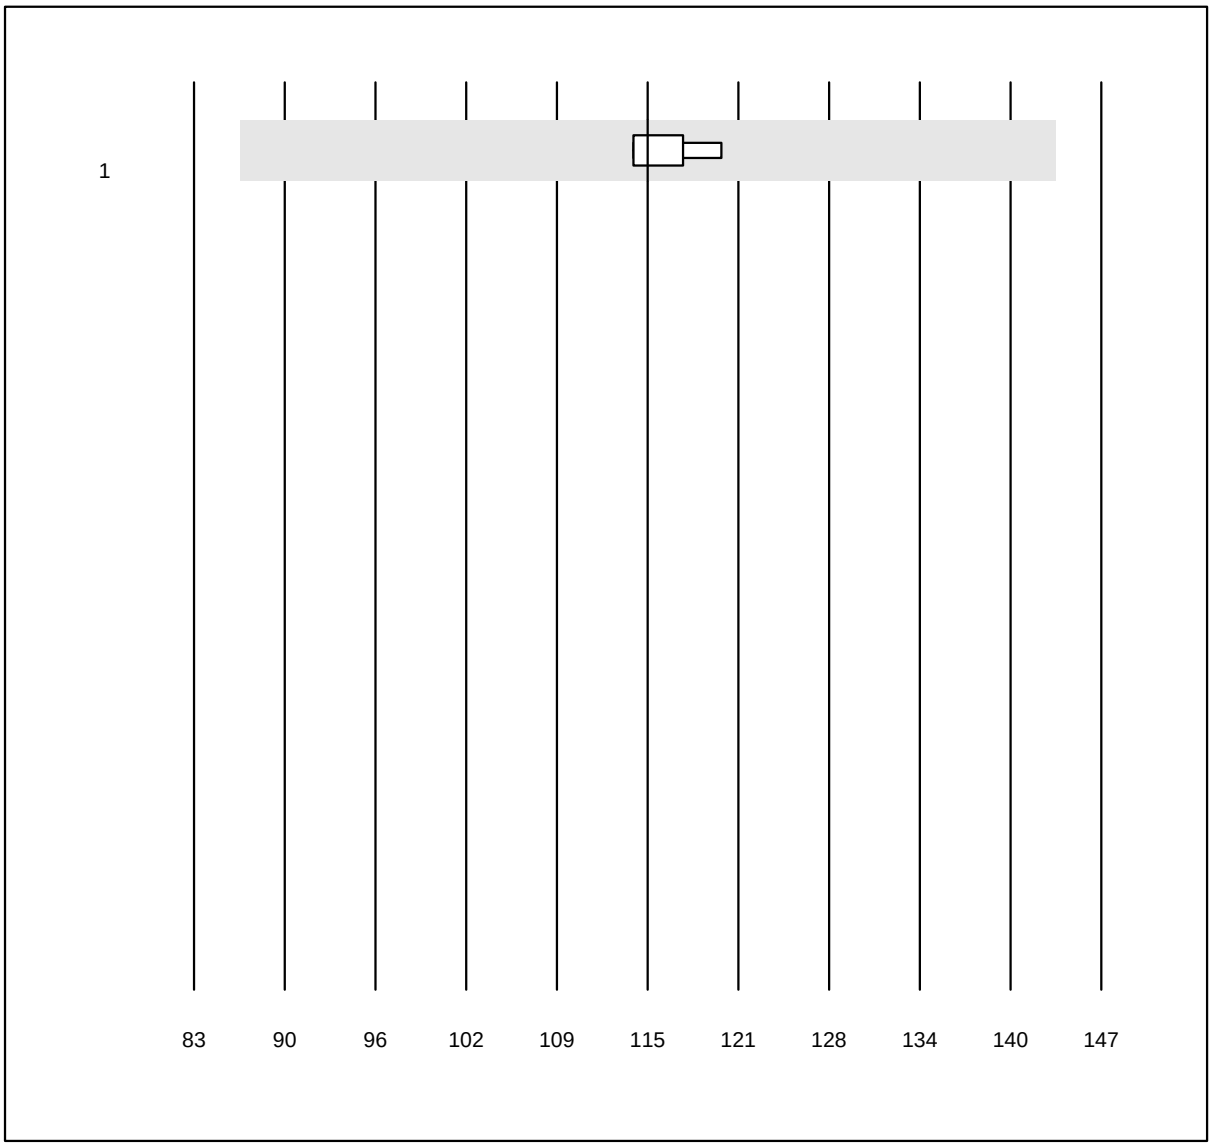


MQ Toleranz: 25%

Paracetamol (µmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	5	100.0	0.0	0.0	115.0	1.8	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Valproat

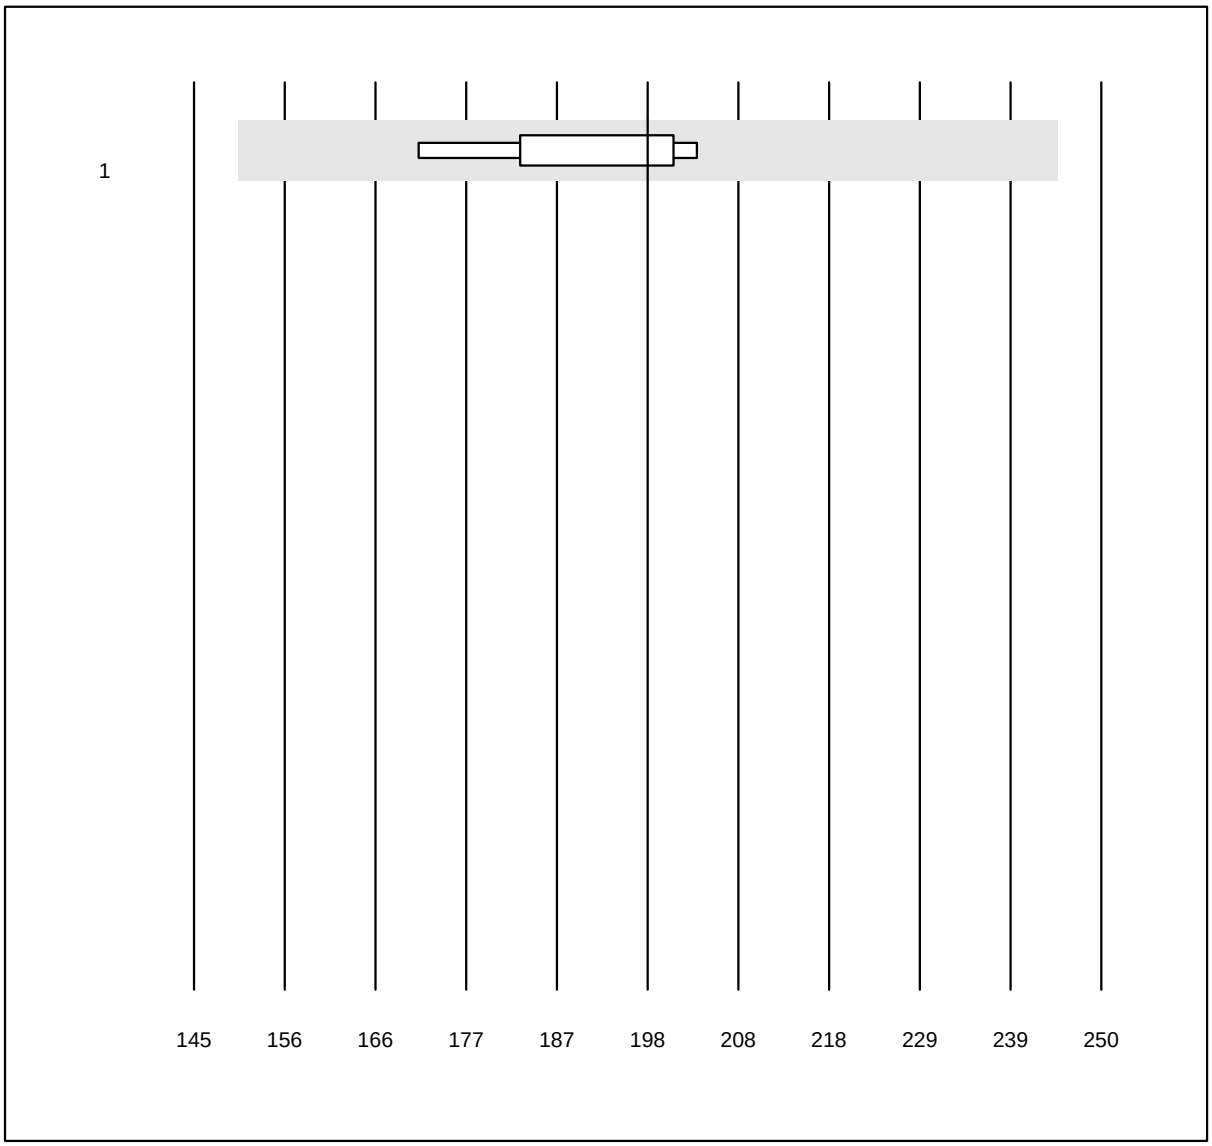


MQ Toleranz: 24%

Valproat (µmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	toutes les méthodes	8	100.0	0.0	0.0	197.5	5.8	e

Vancomycin

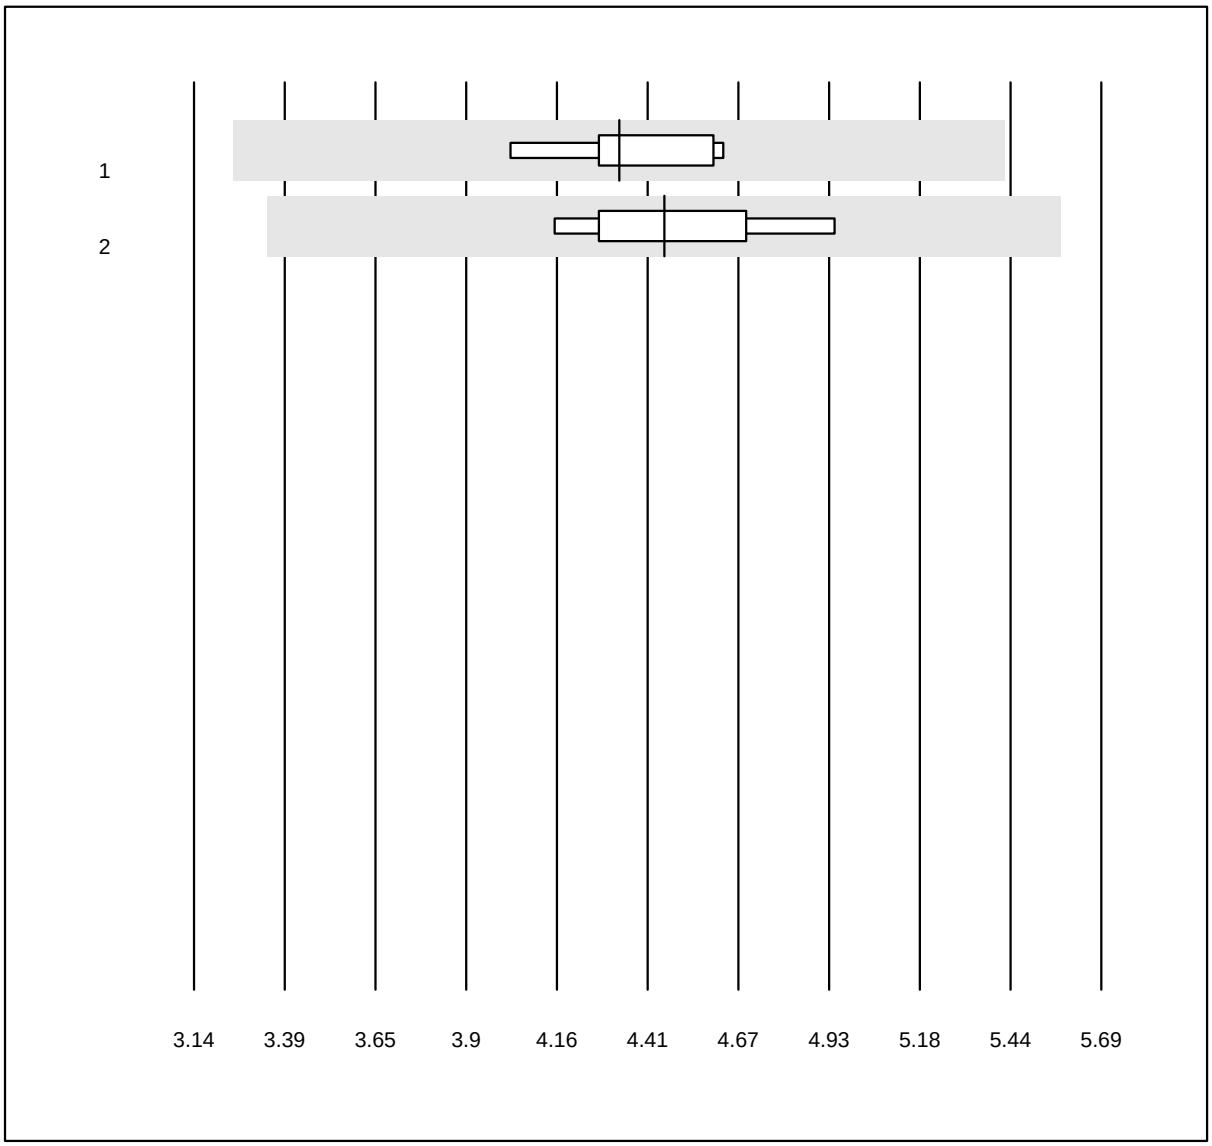


MQ Toleranz: 25%

Vancomycin (µmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	7	100.0	0.0	0.0	4.3	4.4	e
2	Siemens	5	100.0	0.0	0.0	4.5	5.2	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Cystatine C

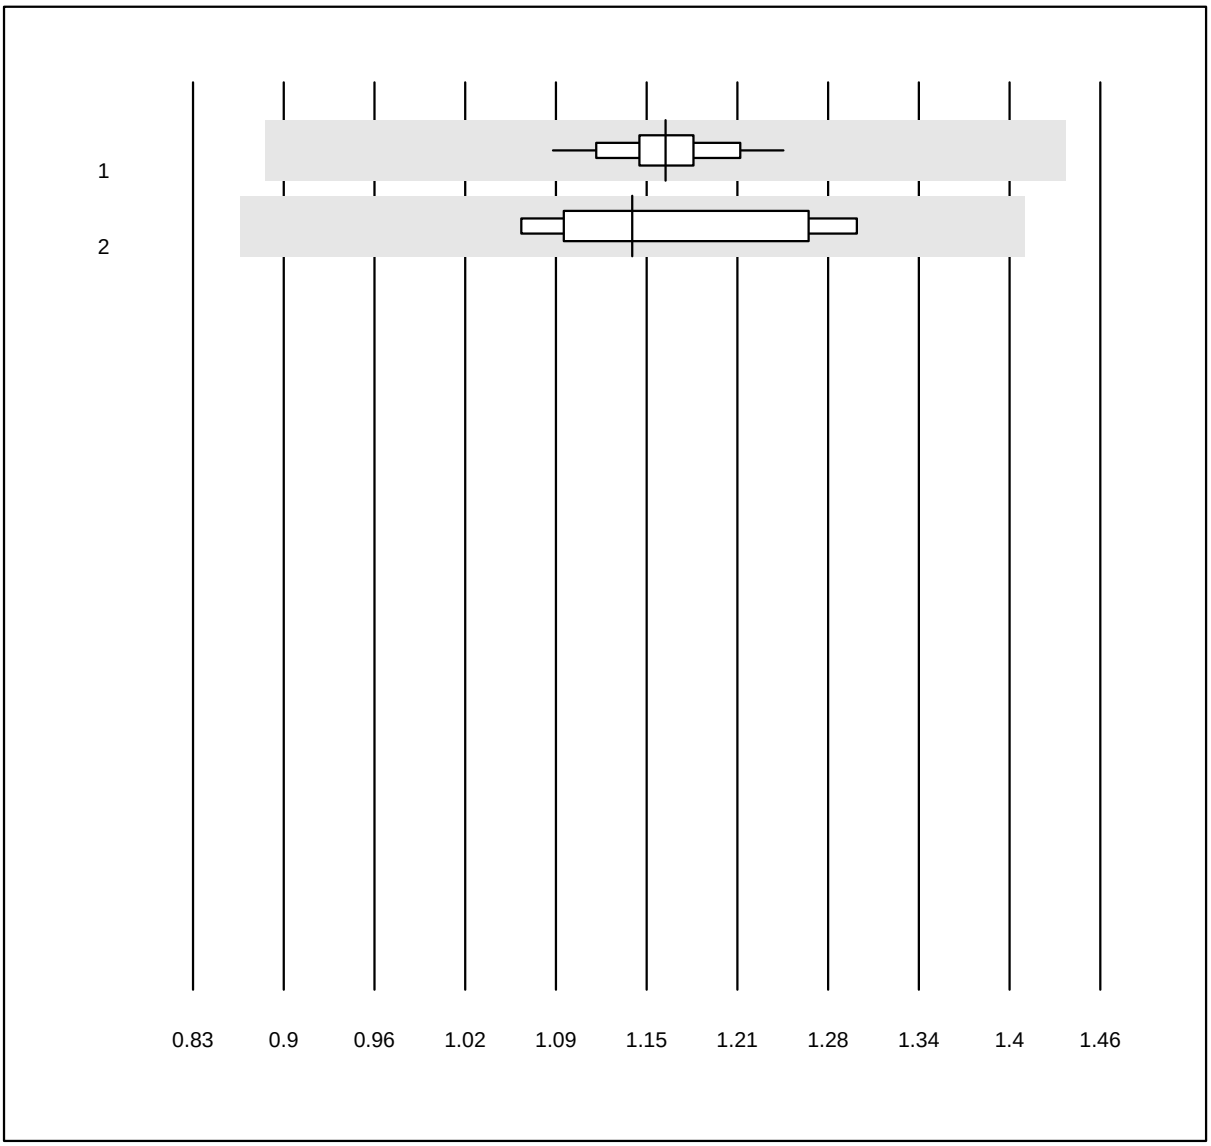


MQ Toleranz: 24%

Cystatine C (mg/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	24	100.0	0.0	0.0	1.16	3.0	e
2	Nephelometrie	8	100.0	0.0	0.0	1.14	7.5	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Ammoniac

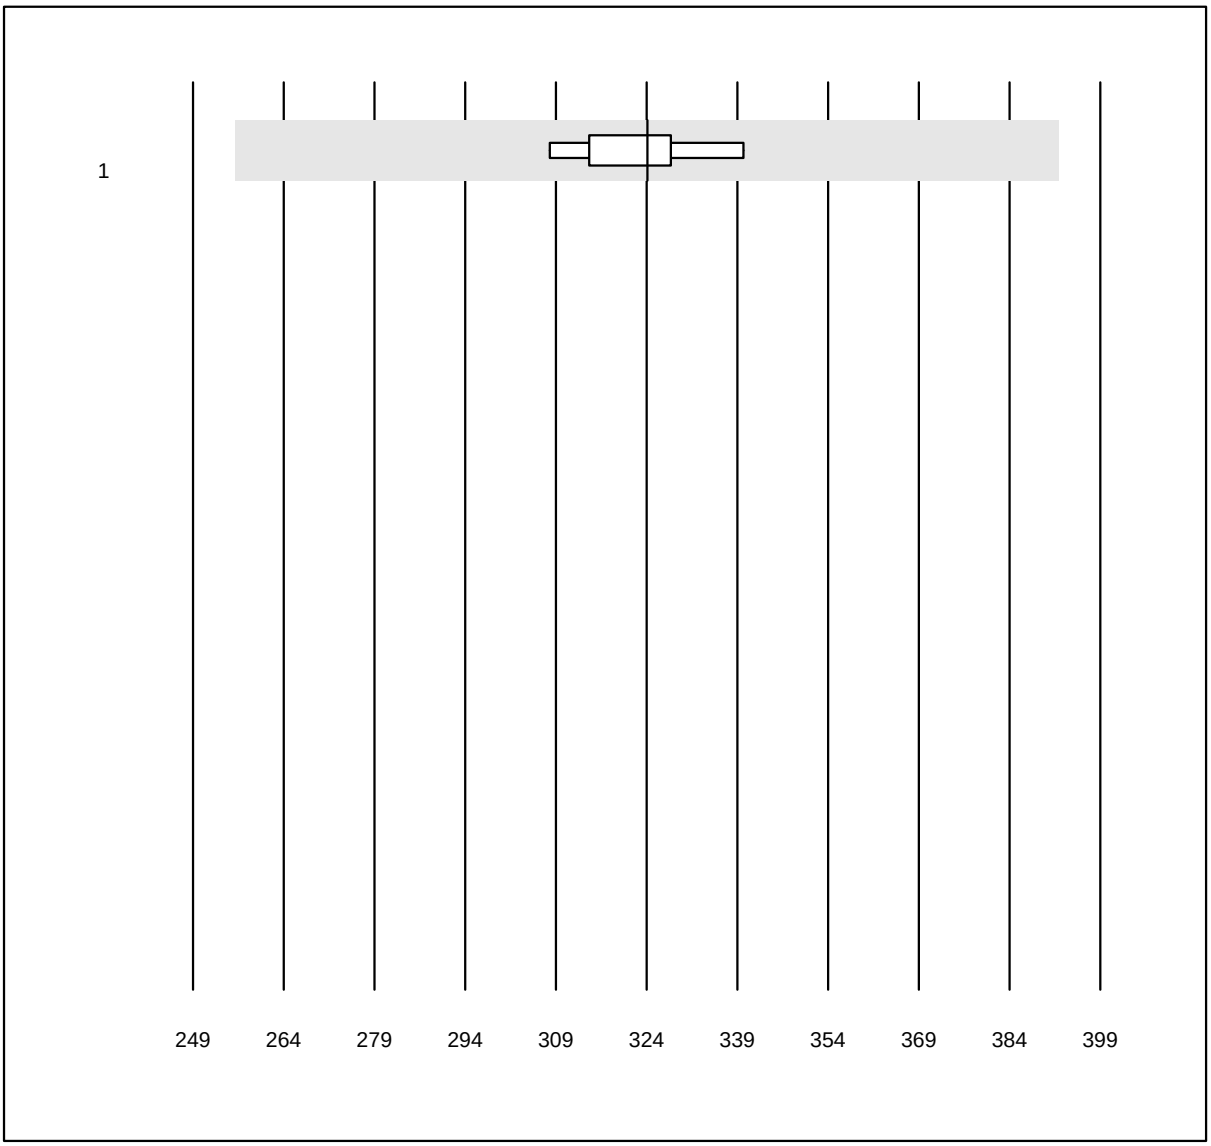


QUALAB Toleranz: 21%

Ammoniac (µmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	10	90.0	0.0	10.0	324.1	3.0	e

3 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Éthanol

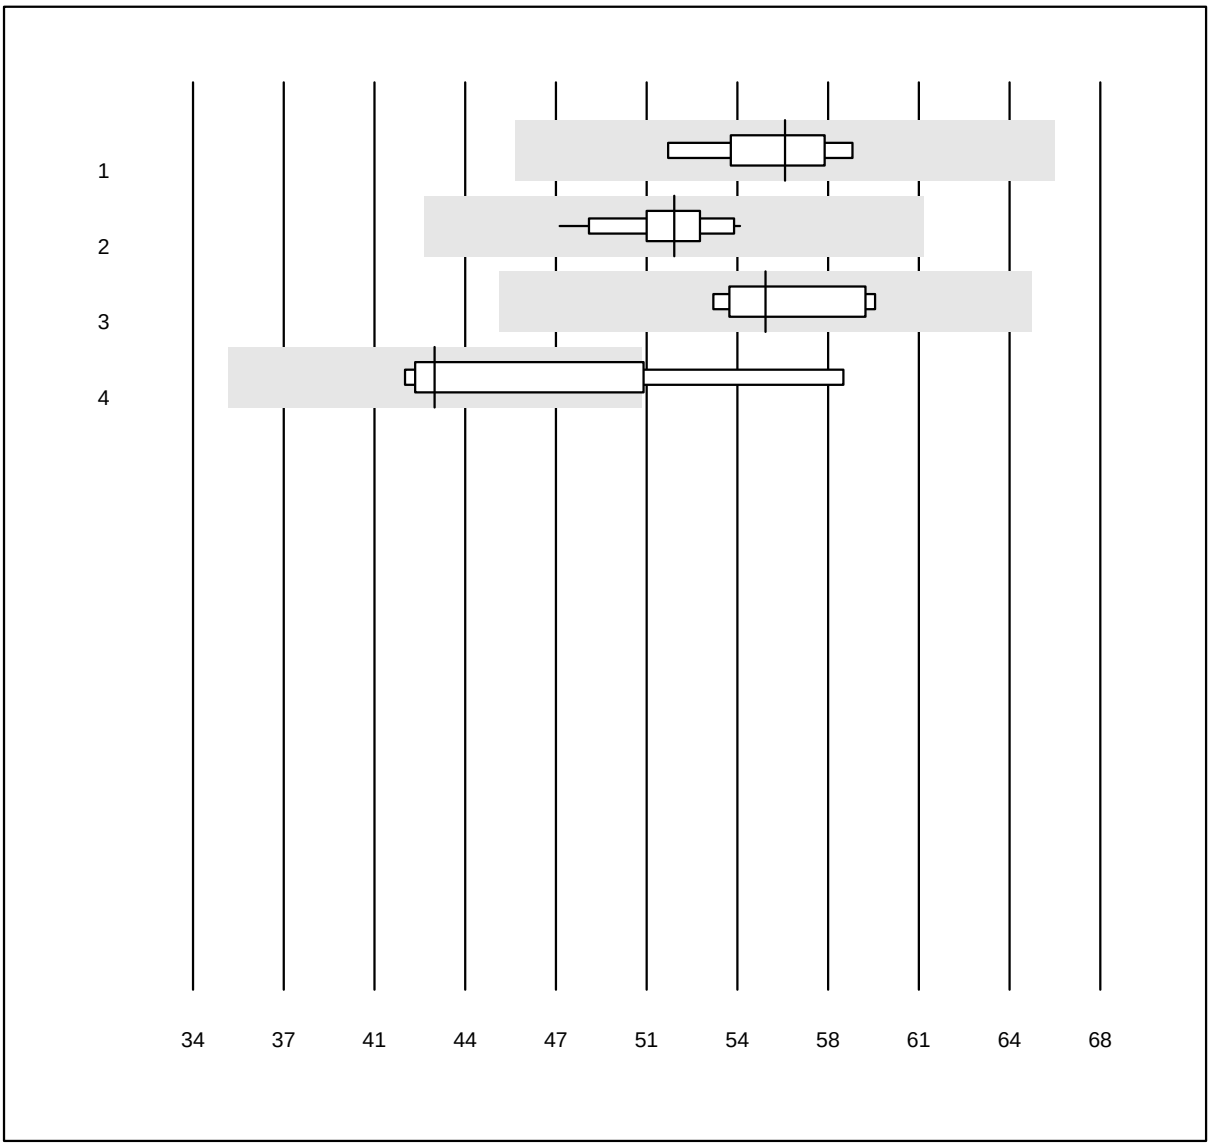


QUALAB Toleranz: 18%

Éthanol (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	5	100.0	0.0	0.0	56.2	3.6	e
2	Roche	28	96.4	0.0	3.6	52.0	3.4	e
3	Siemens	8	87.5	0.0	12.5	55.5	4.2	e
4	Andere	4	75.0	25.0	0.0	43.1	11.7	e*

Calprotectine

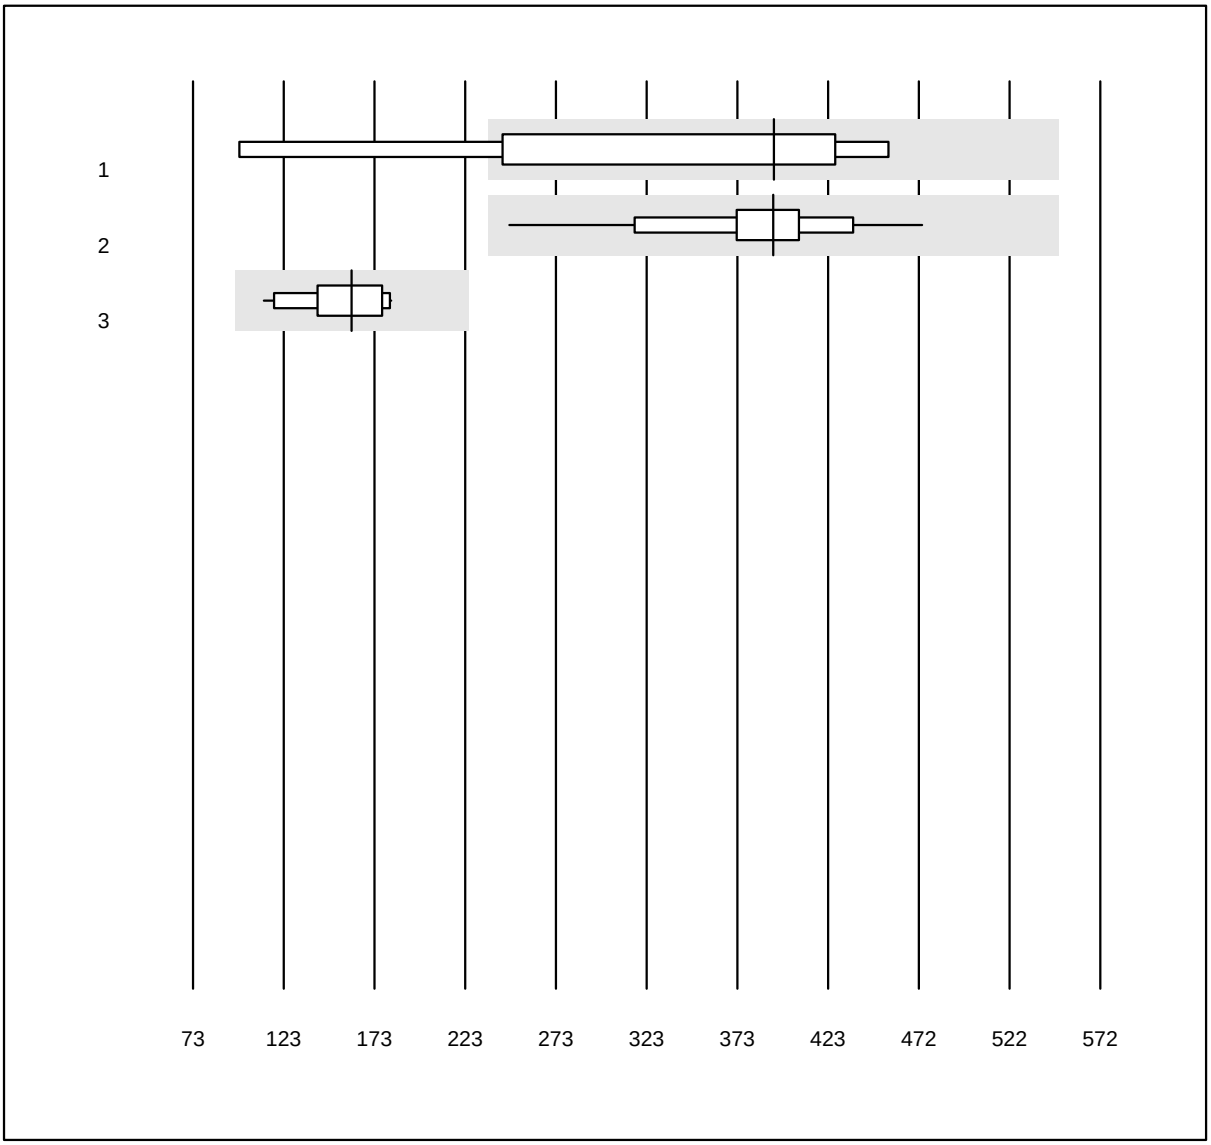


MQ Toleranz: 40%

Calprotectine (µg/g)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Bühlmann Quantum Blue	4	75.0	25.0	0.0	393	30.5	e*
2	Bühlmann fCALturbo	23	95.7	0.0	4.3	392	12.0	e
3	Liaison	16	100.0	0.0	0.0	160	14.0	e

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Cholestérol Af/b101

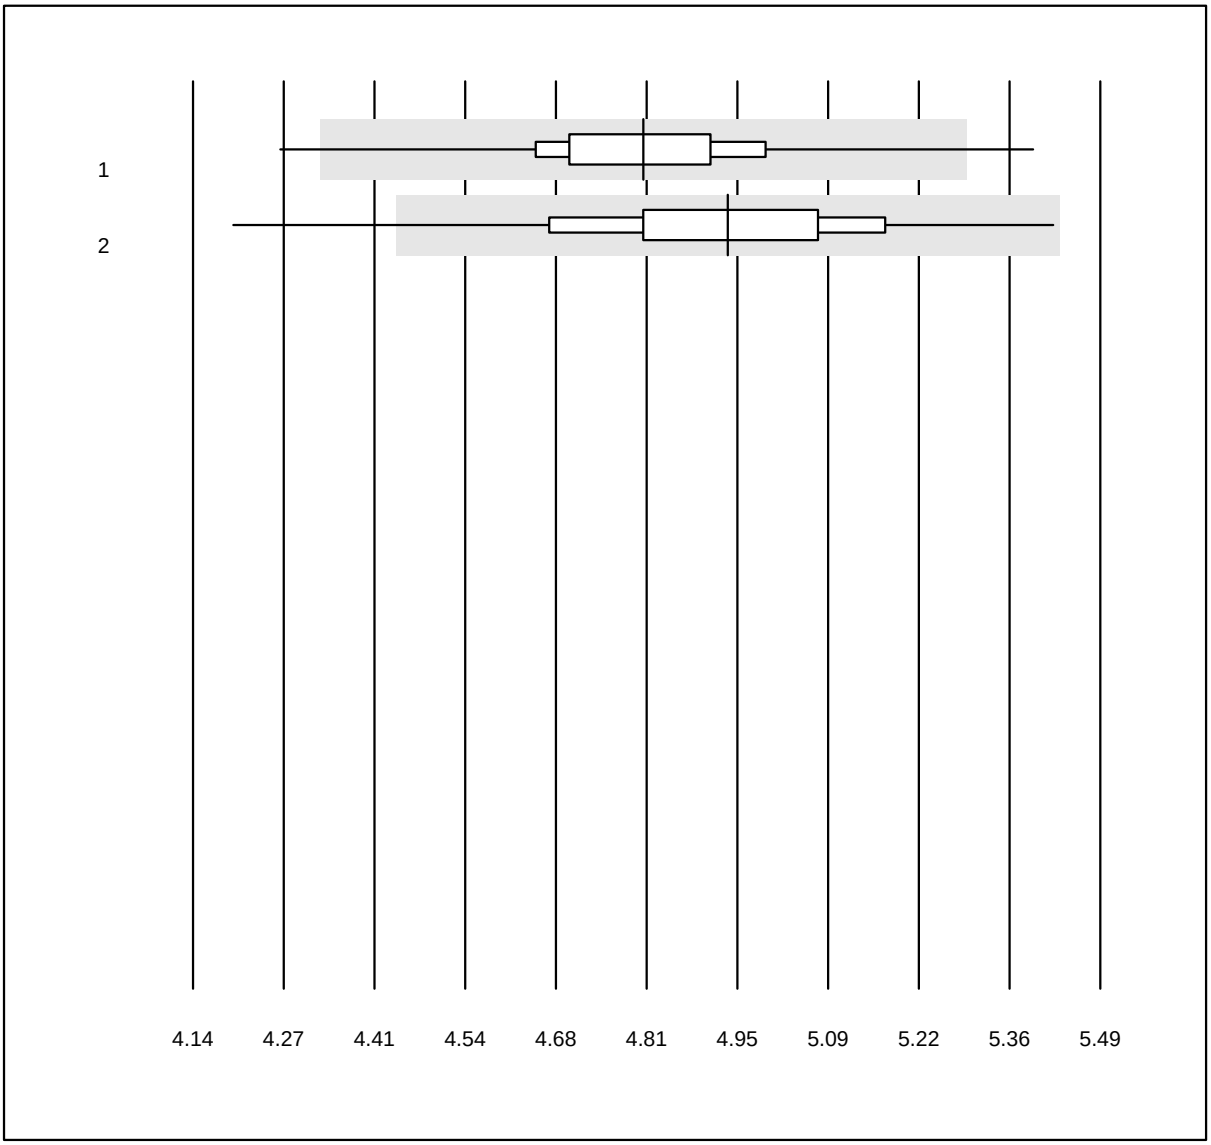


QUALAB Toleranz: 10%

Cholestérol Af/b101
(mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Cobas b101/Click	369	98.6	0.8	0.5	4.81	2.8	e
2	Afinion	514	98.4	0.6	1.0	4.94	3.8	e

HDL-Cholestérol Af/b101

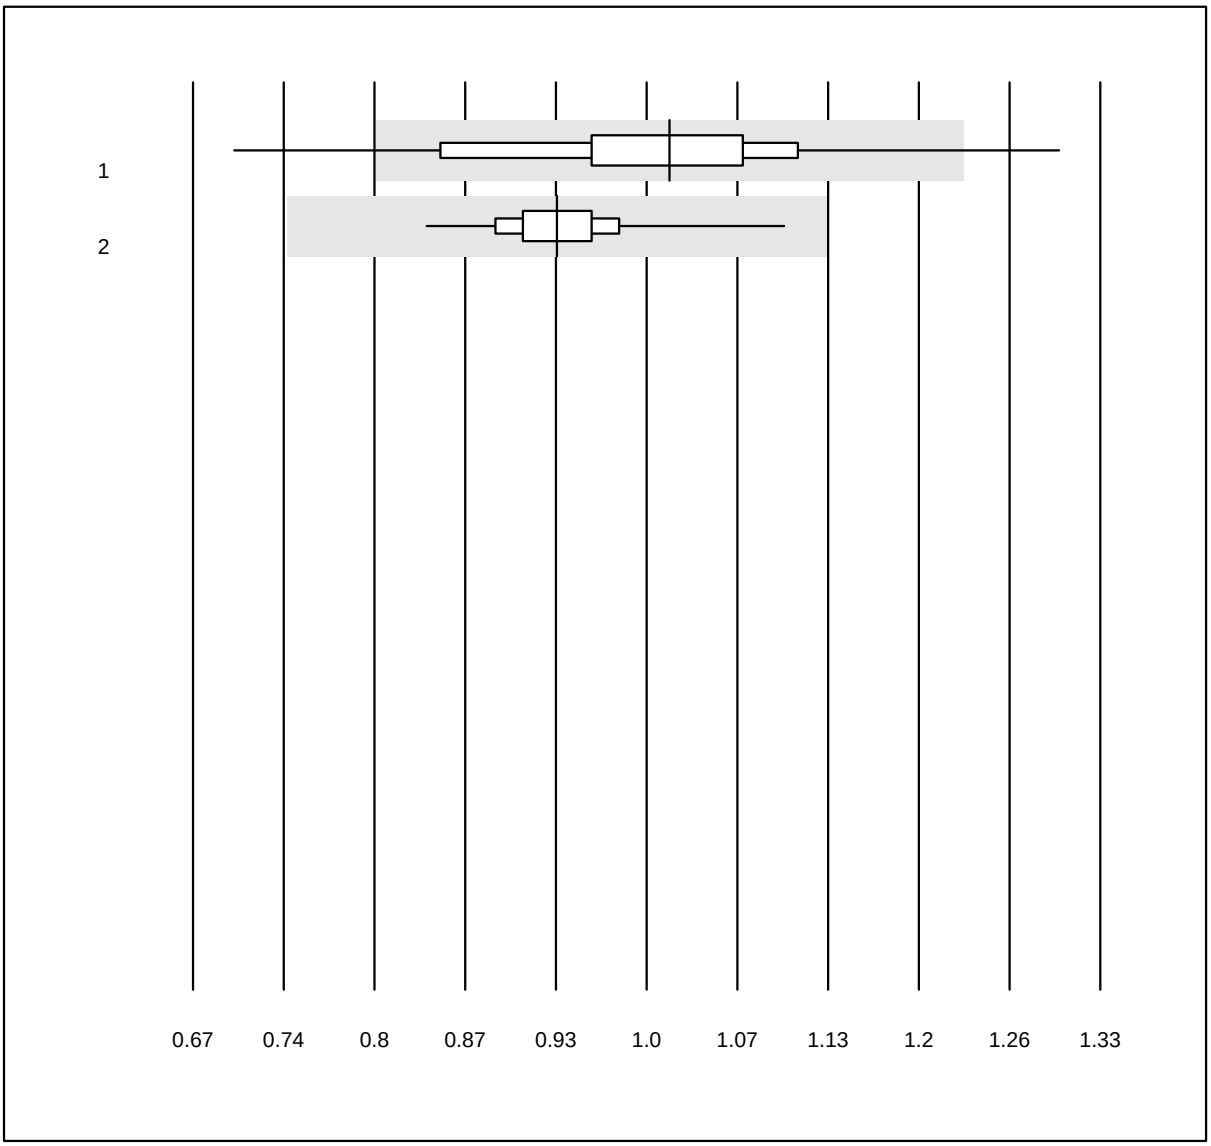


QUALAB Toleranz: 21%

HDL-Cholestérol Af/b101
(mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Cobas b101/Click	367	92.6	4.4	3.0	1.02	9.9	e
2	Afinion	514	97.1	0.0	2.9	0.93	3.9	e

Triglycerides Af/b101

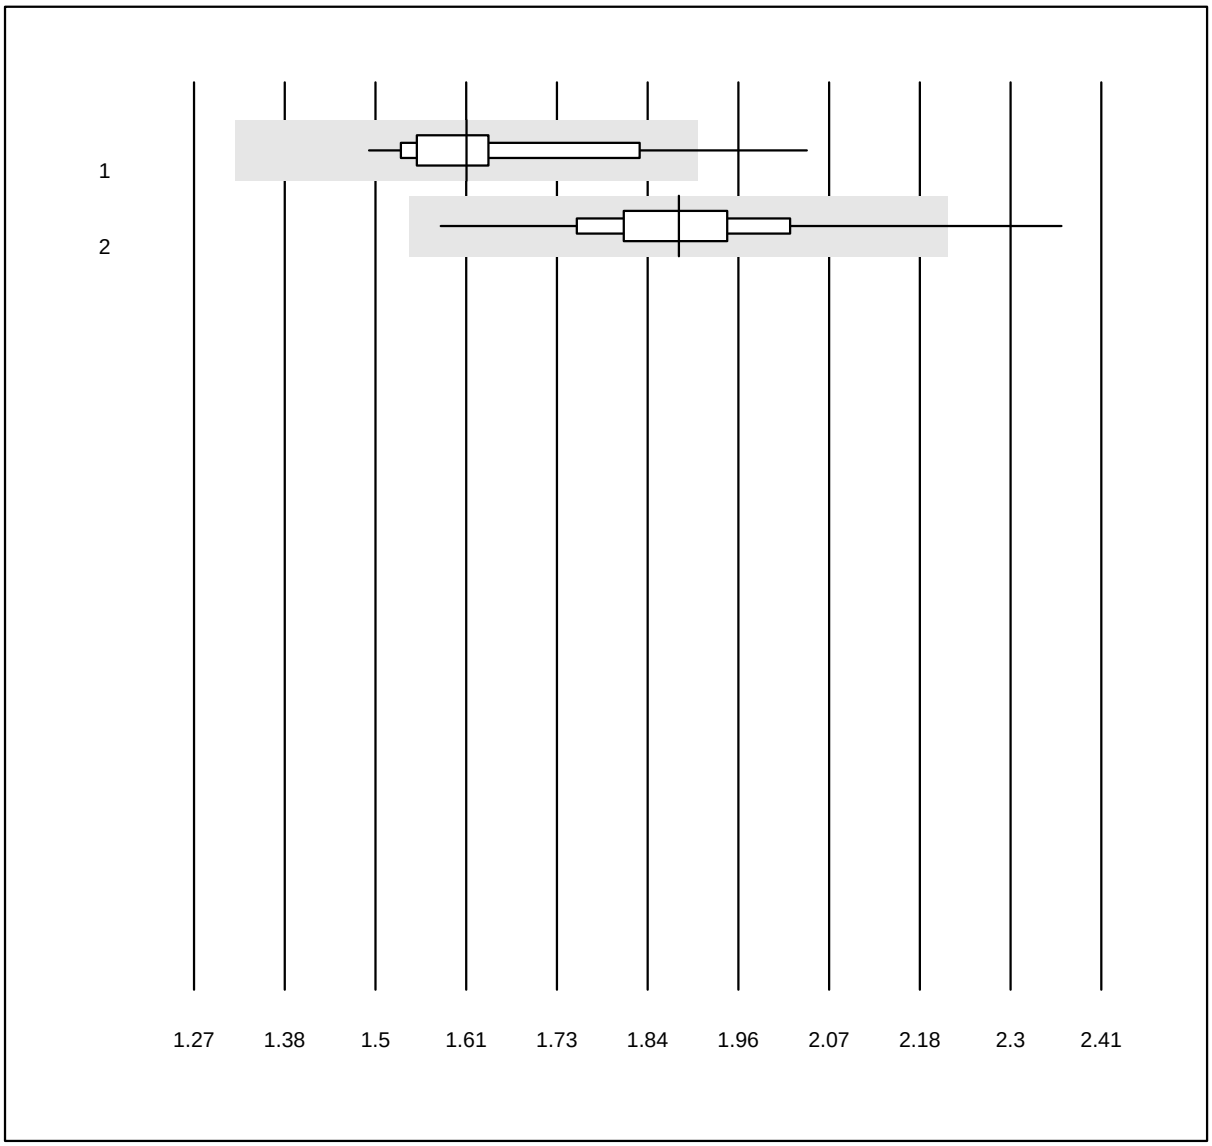


QUALAB Toleranz: 18%

Triglycerides Af/b101
(mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Cobas b101/Click	367	93.7	3.3	3.0	1.61	7.0	e
2	Afinion	515	98.1	1.0	1.0	1.88	6.0	e

Troponine I AFIAS

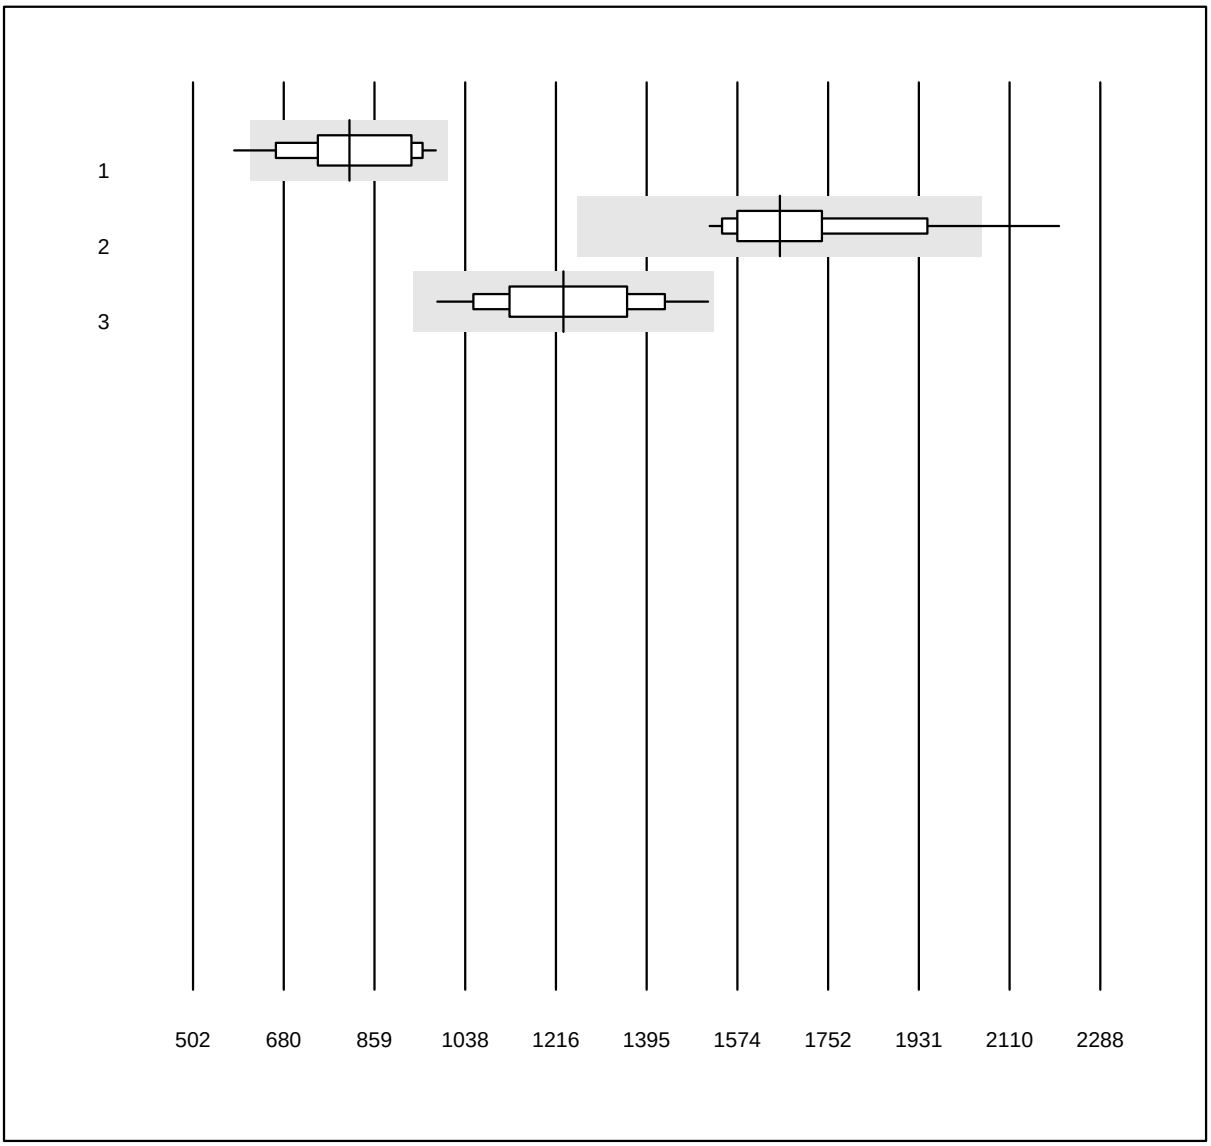


QUALAB Toleranz: 24%

Troponine I AFIAS (ng/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Afias (Lot-Gen 1)	131	97.7	2.3	0.0	810.00	12.9	a
2	Afias (Lot-Gen 2)	87	94.3	3.4	2.3	1657.28	9.1	e
3	AFIAS	487	92.2	0.0	7.8	1231.28	11.2	e

NT-proBNP AFIAS

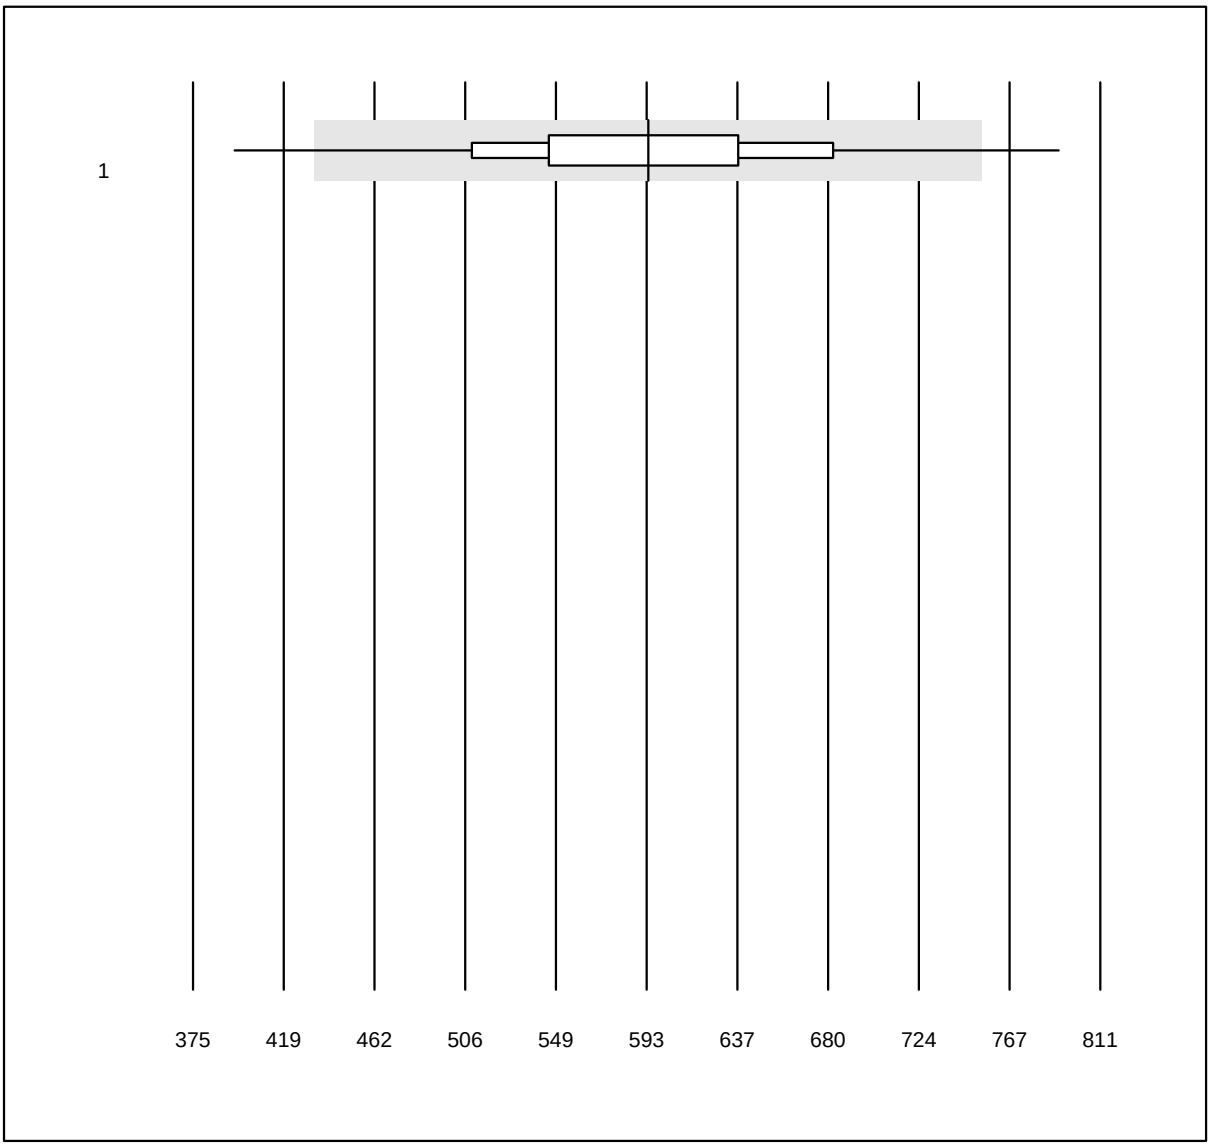


QUALAB Toleranz: 27%

NT-proBNP AFIAS (ng/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	AFIAS	549	94.0	2.7	3.3	593.8	11.3	e

Homocystein

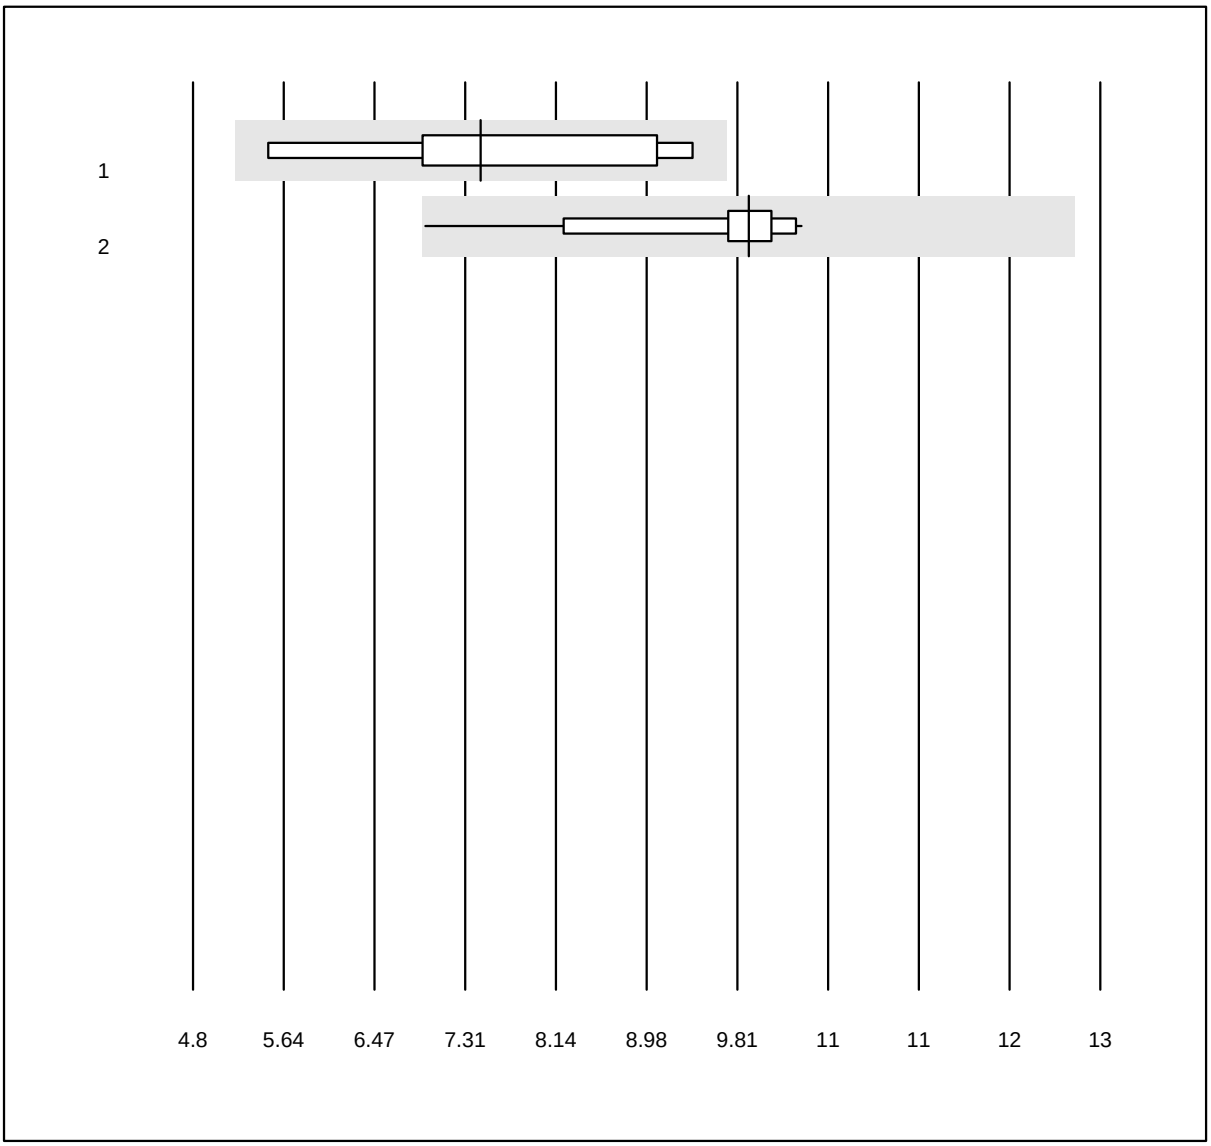


MQ Toleranz: 30%

Homocystein (µmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	8	100.0	0.0	0.0	7.4	16.4	e*
2	Roche	14	100.0	0.0	0.0	9.8	8.6	e

Bicarbonate

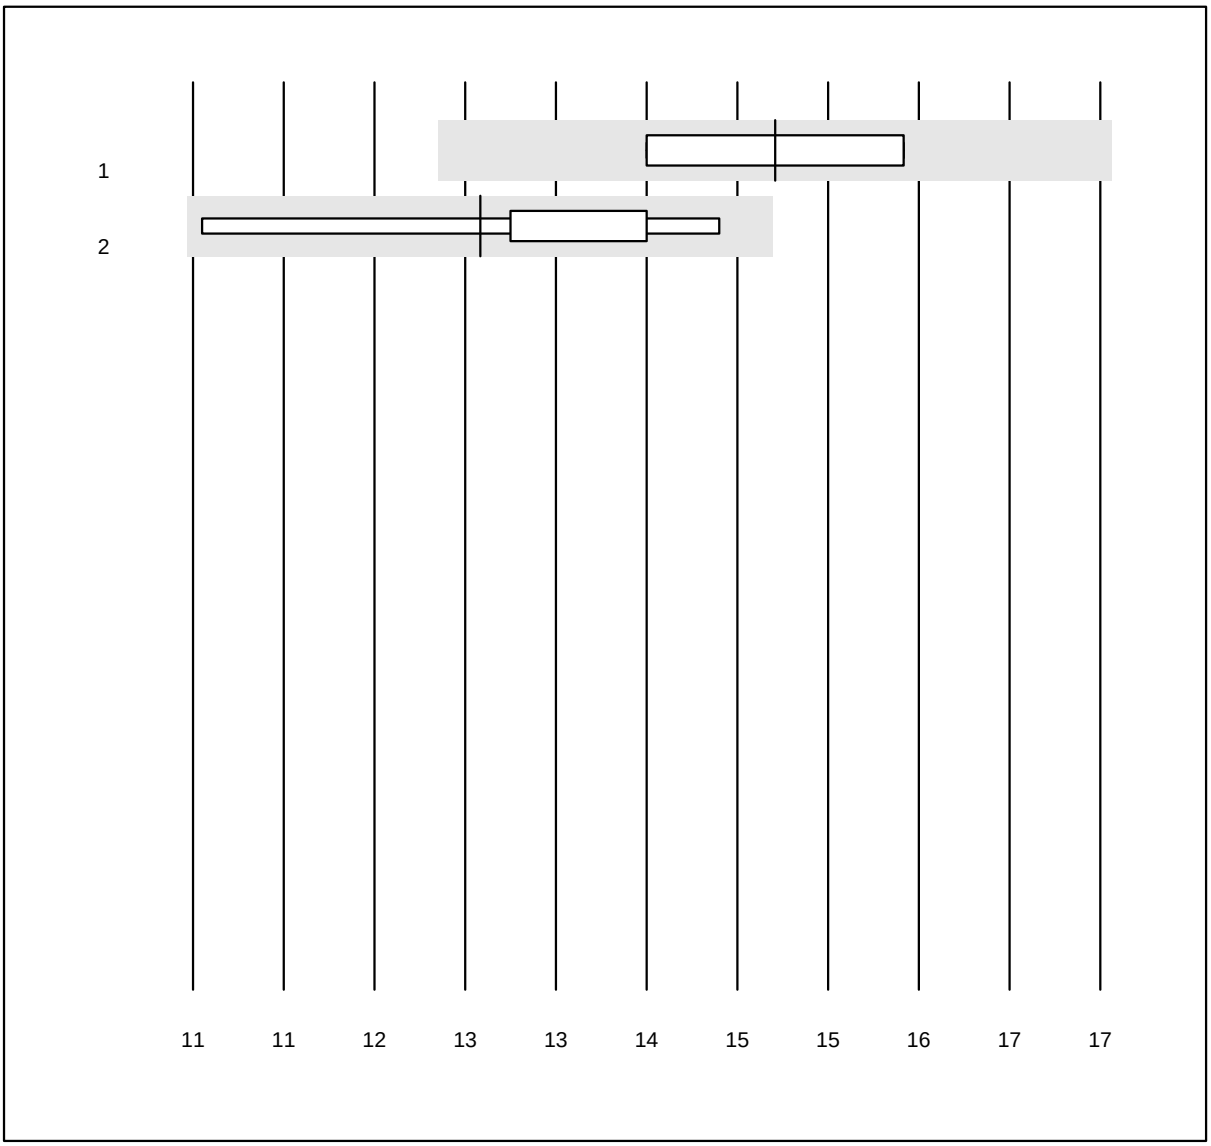


MQ Toleranz: 15%

Bicarbonate (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	4	100.0	0.0	0.0	14.8	6.6	e*
2	Roche	7	100.0	0.0	0.0	12.9	7.4	a*

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Fructosamine

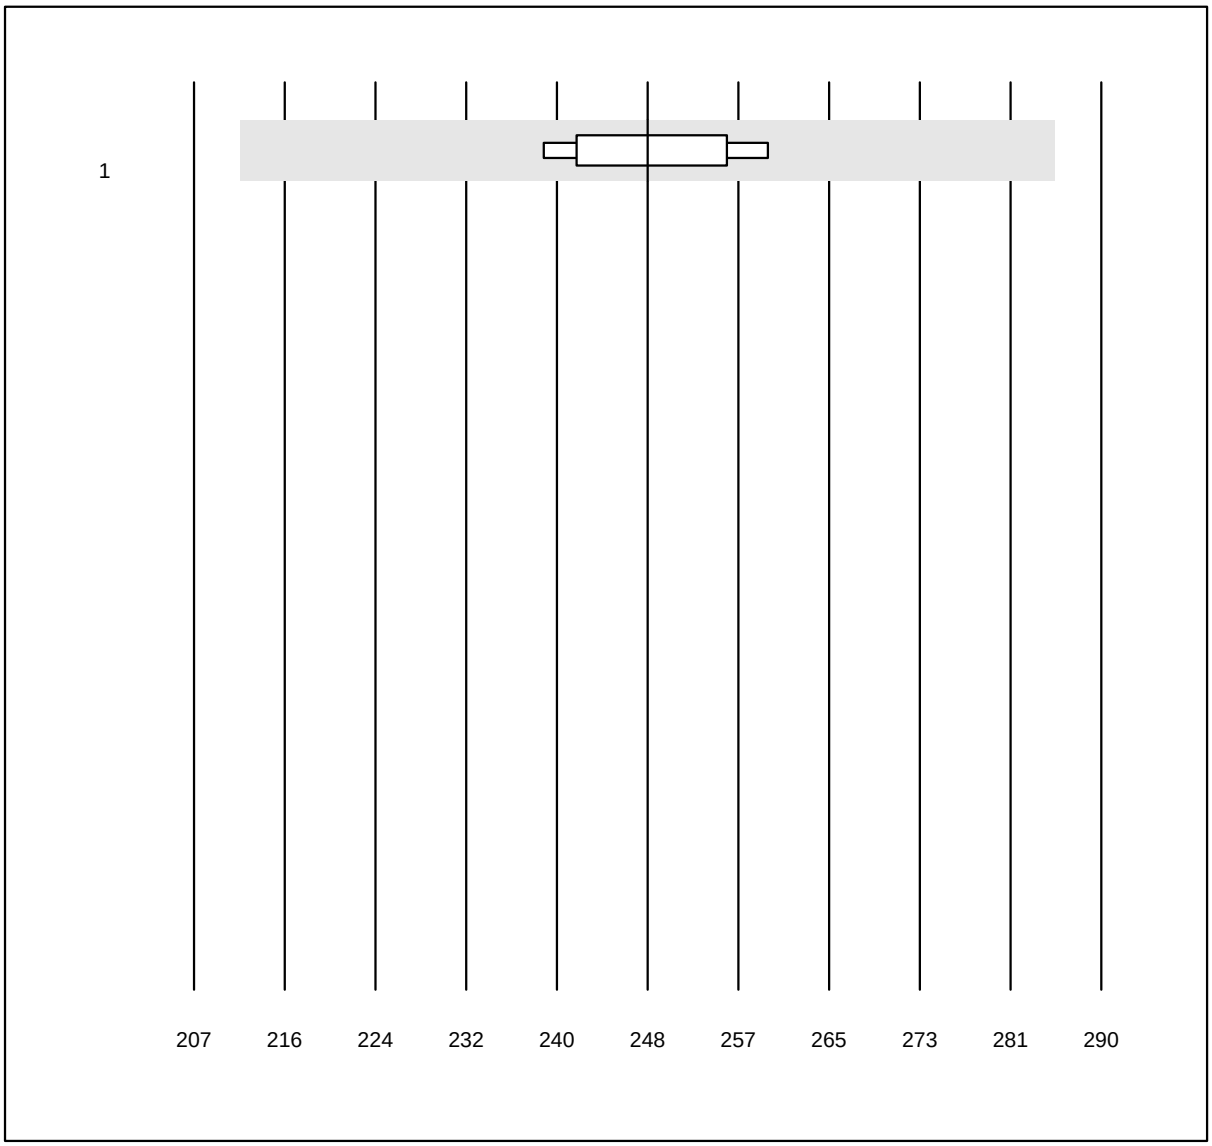


MQ Toleranz: 15%

Fructosamine (µmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Chimie humide	4	100.0	0.0	0.0	249	2.9	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Lipase

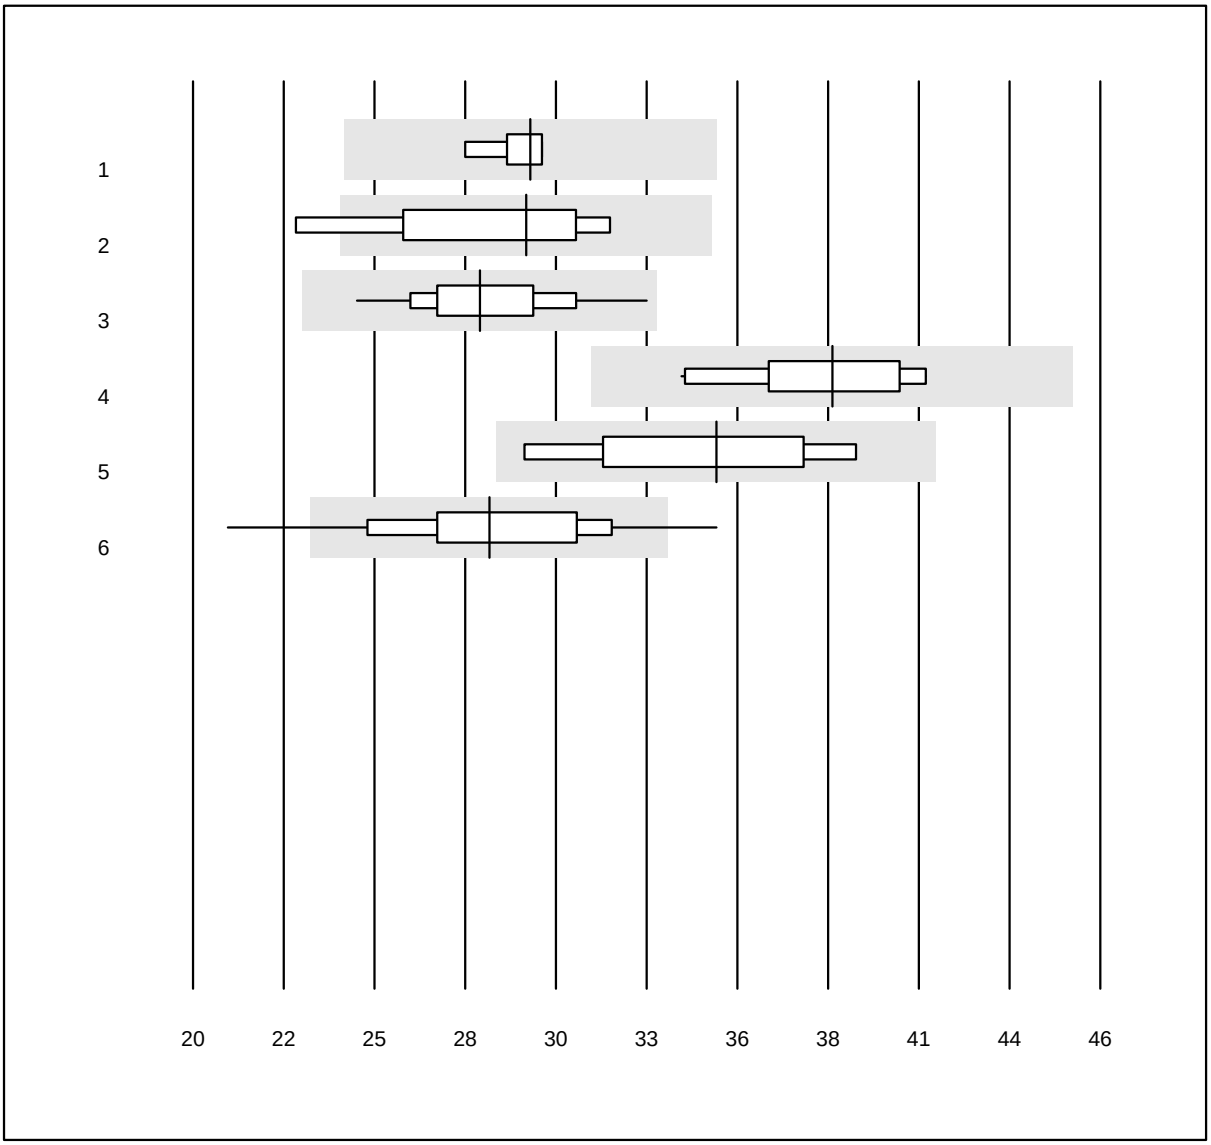


QUALAB Toleranz: 18%

Lipase (U/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	7	100.0	0.0	0.0	29.7	2.7	e
2	Beckman	4	100.0	0.0	0.0	29.6	9.4	e*
3	Roche	40	100.0	0.0	0.0	28.2	6.7	e
4	Siemens	10	100.0	0.0	0.0	38.3	6.4	e
5	Autolyser	4	100.0	0.0	0.0	35.0	8.6	e*
6	Fuji Dri-Chem	121	83.5	7.4	9.1	28.5	10.6	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Lipase Vitros

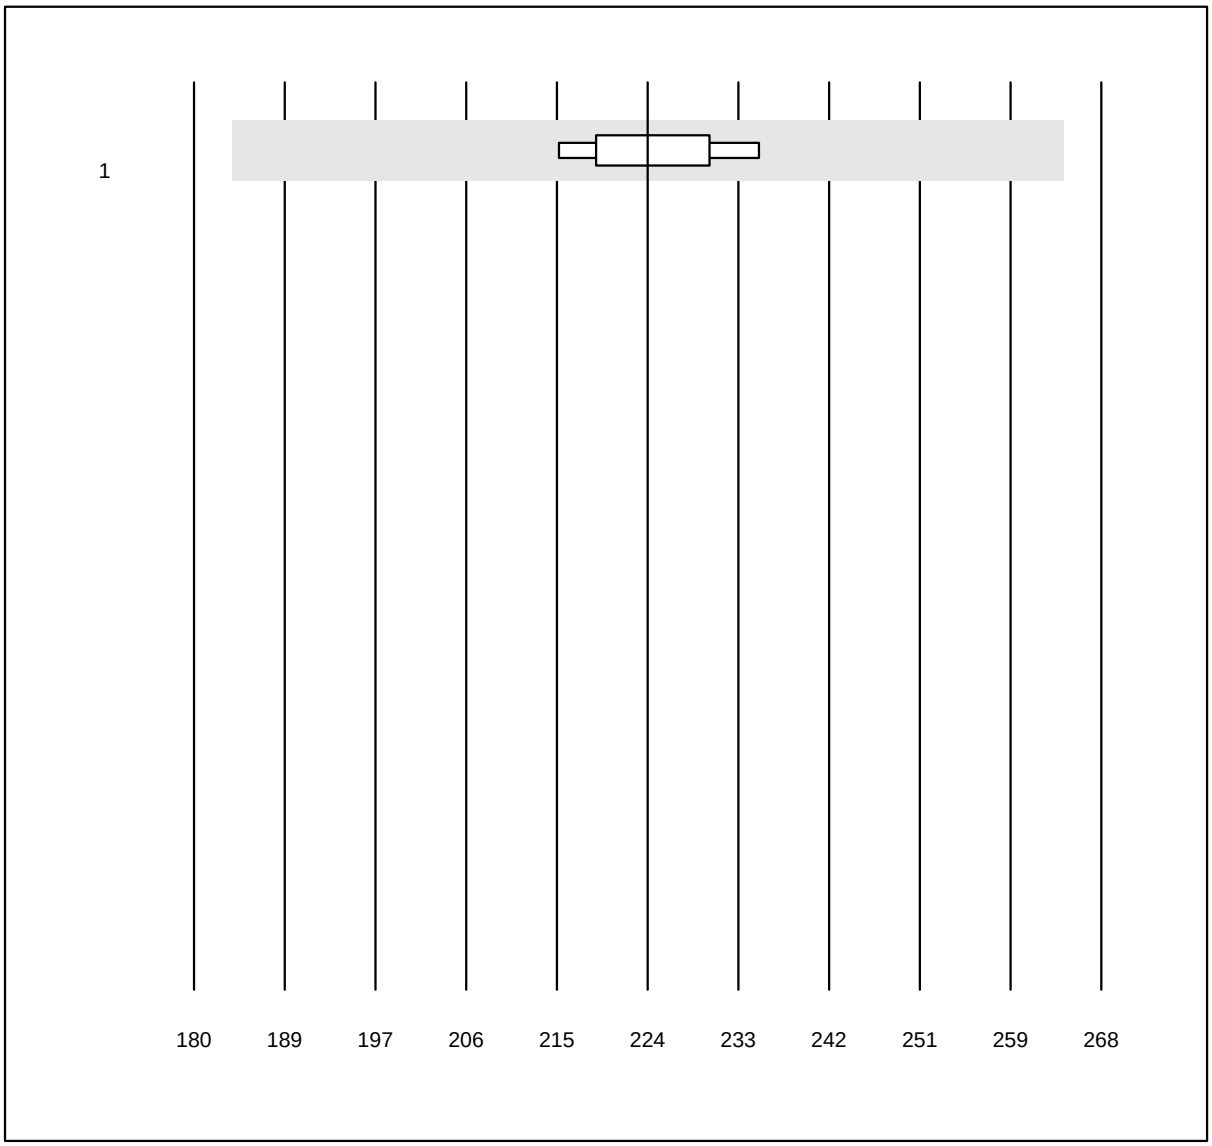


QUALAB Toleranz: 18%

Lipase Vitros (U/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Vitros	7	100.0	0.0	0.0	224.0	2.8	e

Albumine CSF

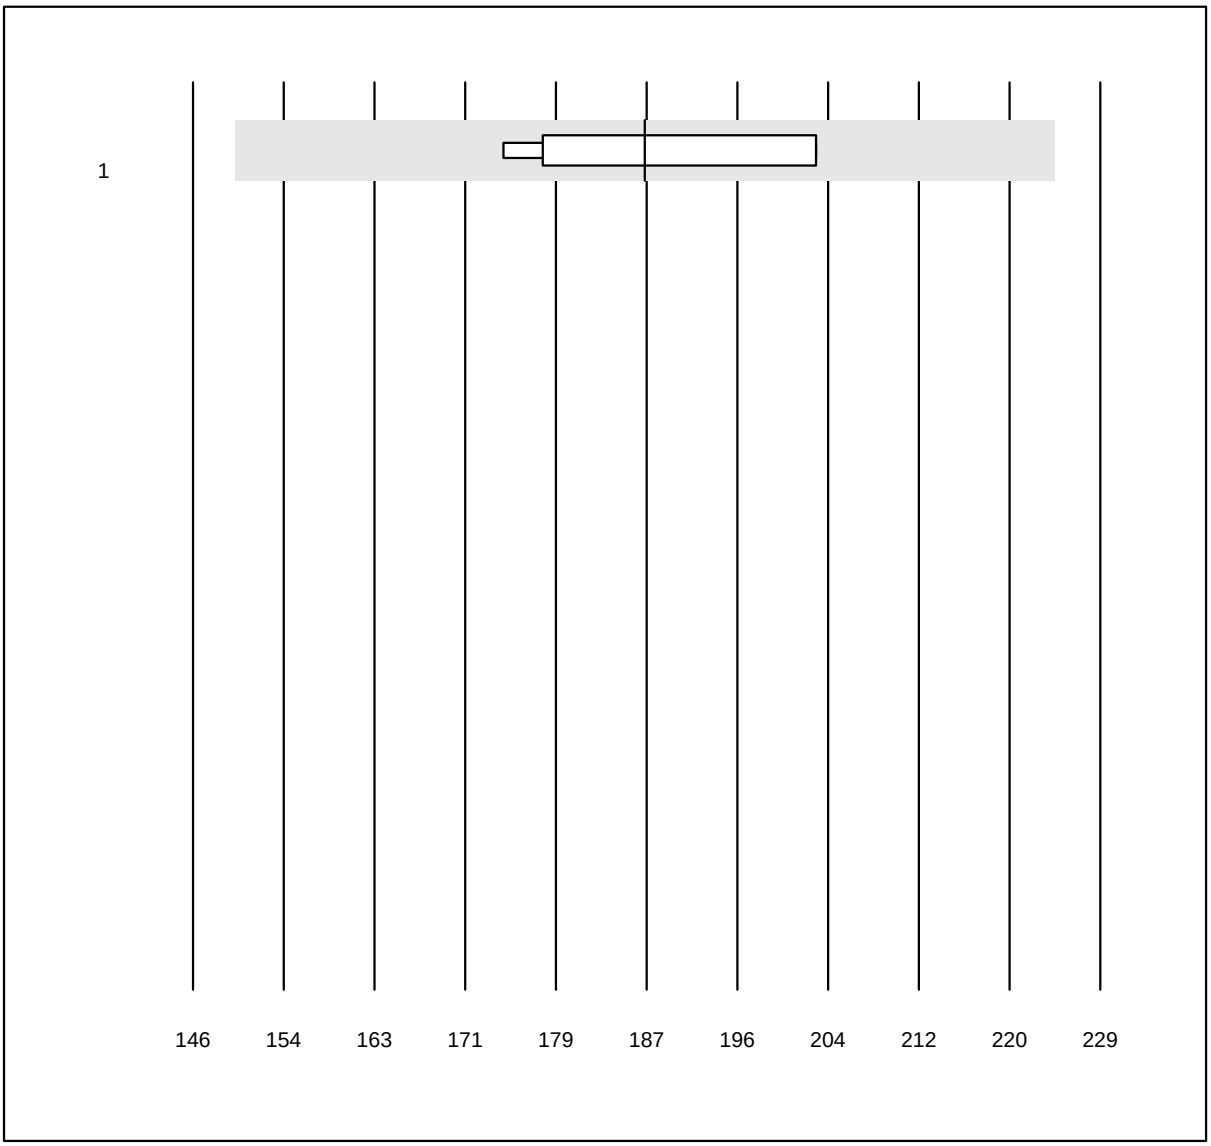


MQ Toleranz: 20%

Albumine CSF (mg/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	7	100.0	0.0	0.0	187.33	6.0	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)


Glucose CSF

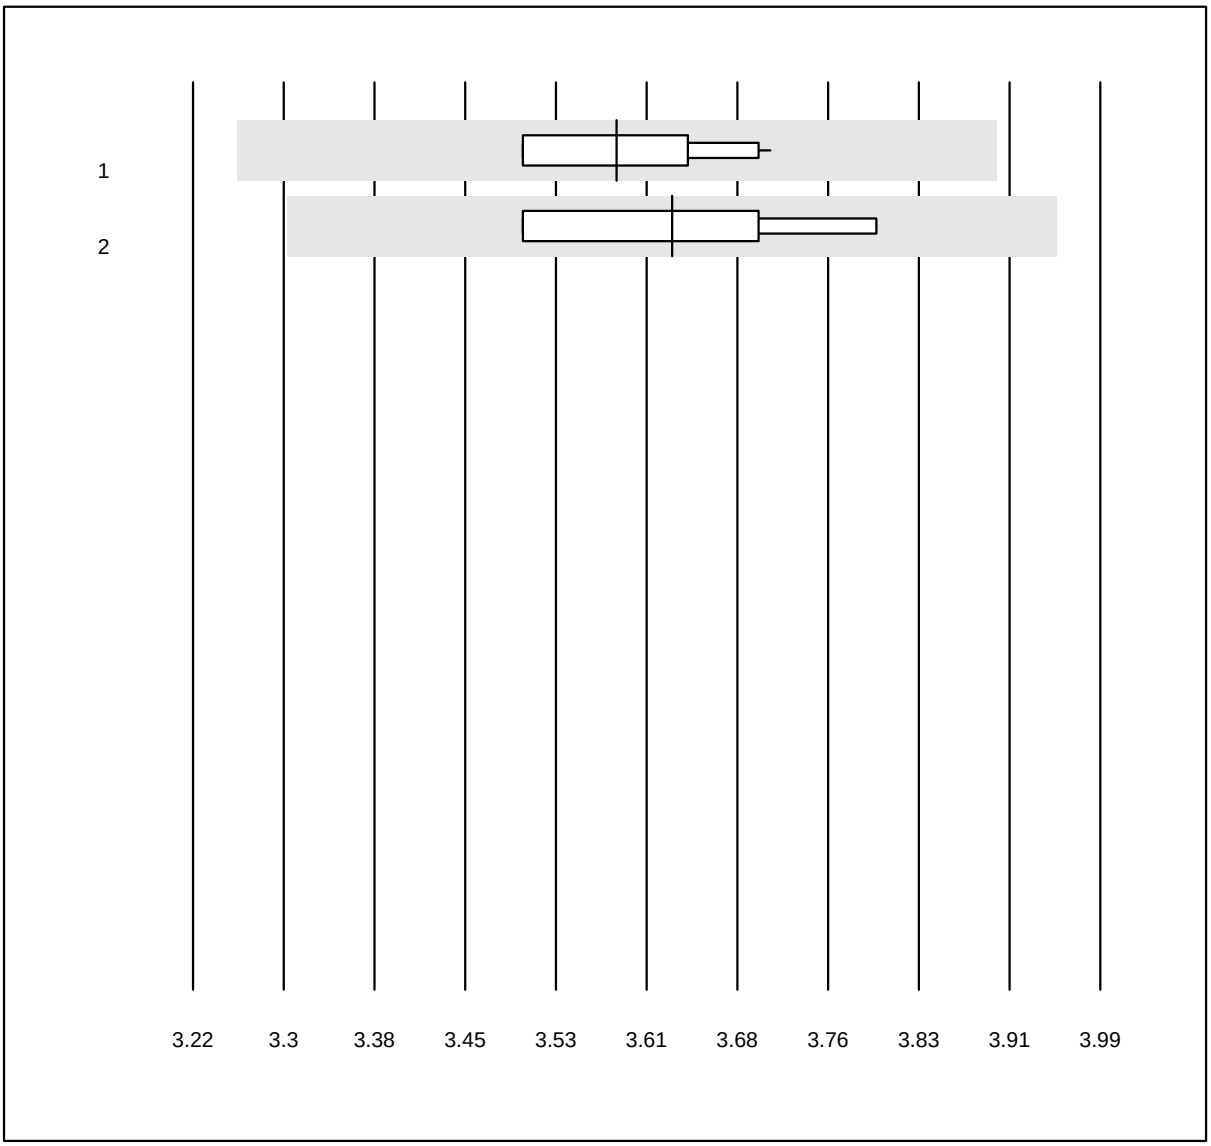

QUALAB Toleranz: 9% Glucose CSF (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	23	100.0	0.0	0.0	3.58	2.1	e
2	Autres méthodes	15	100.0	0.0	0.0	3.63	2.8	e

Lactate CSF

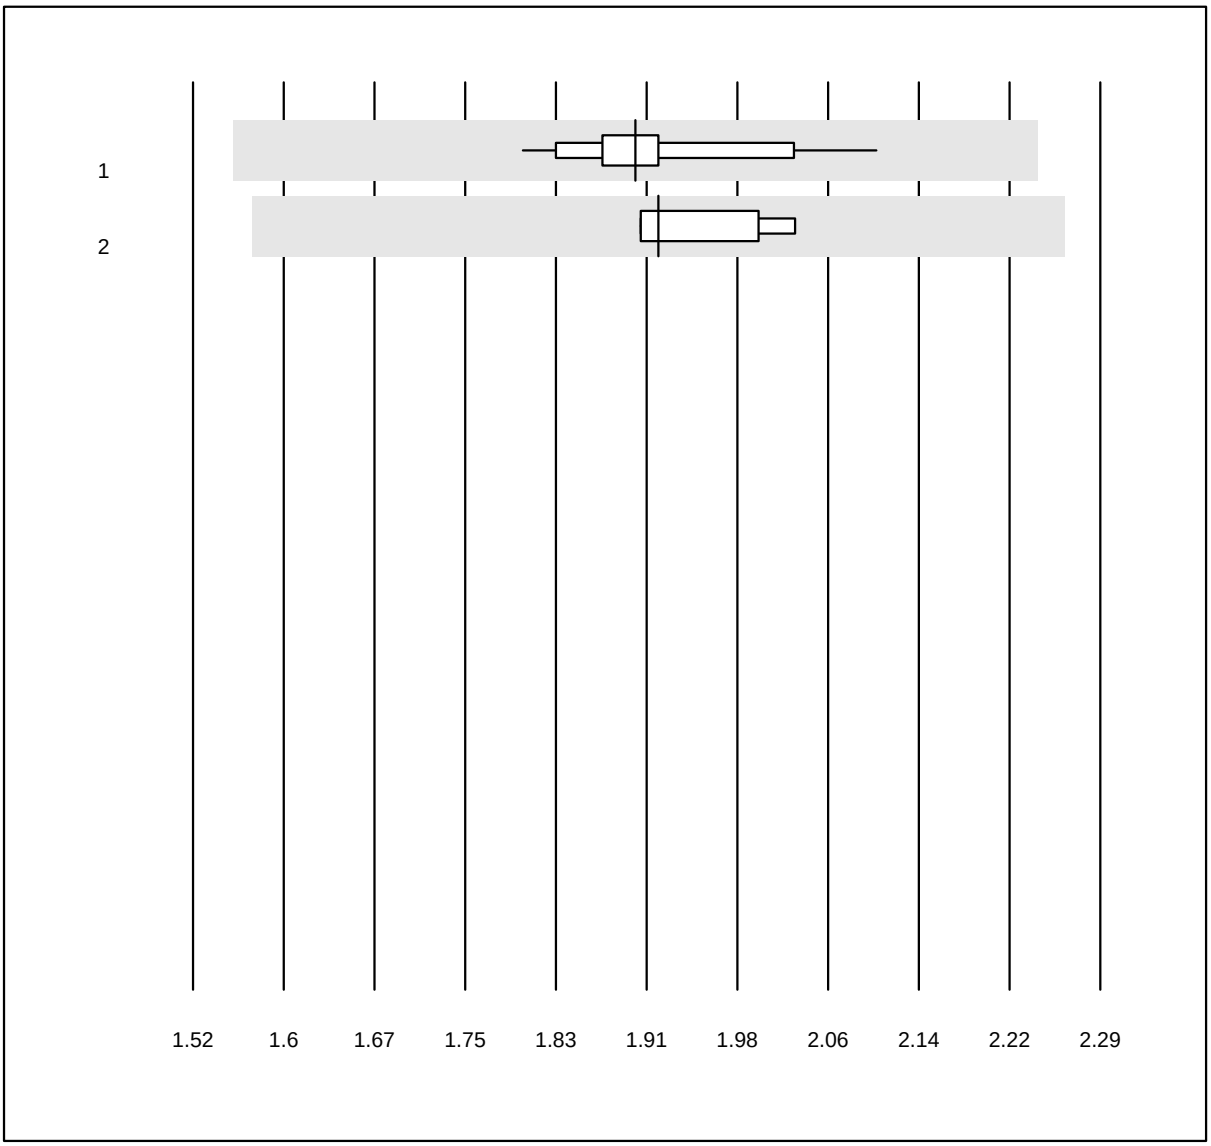


QUALAB Toleranz: 18%

Lactate CSF (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	16	100.0	0.0	0.0	1.90	3.6	e
2	Autres méthodes	8	100.0	0.0	0.0	1.92	2.8	e

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

LDH CSF

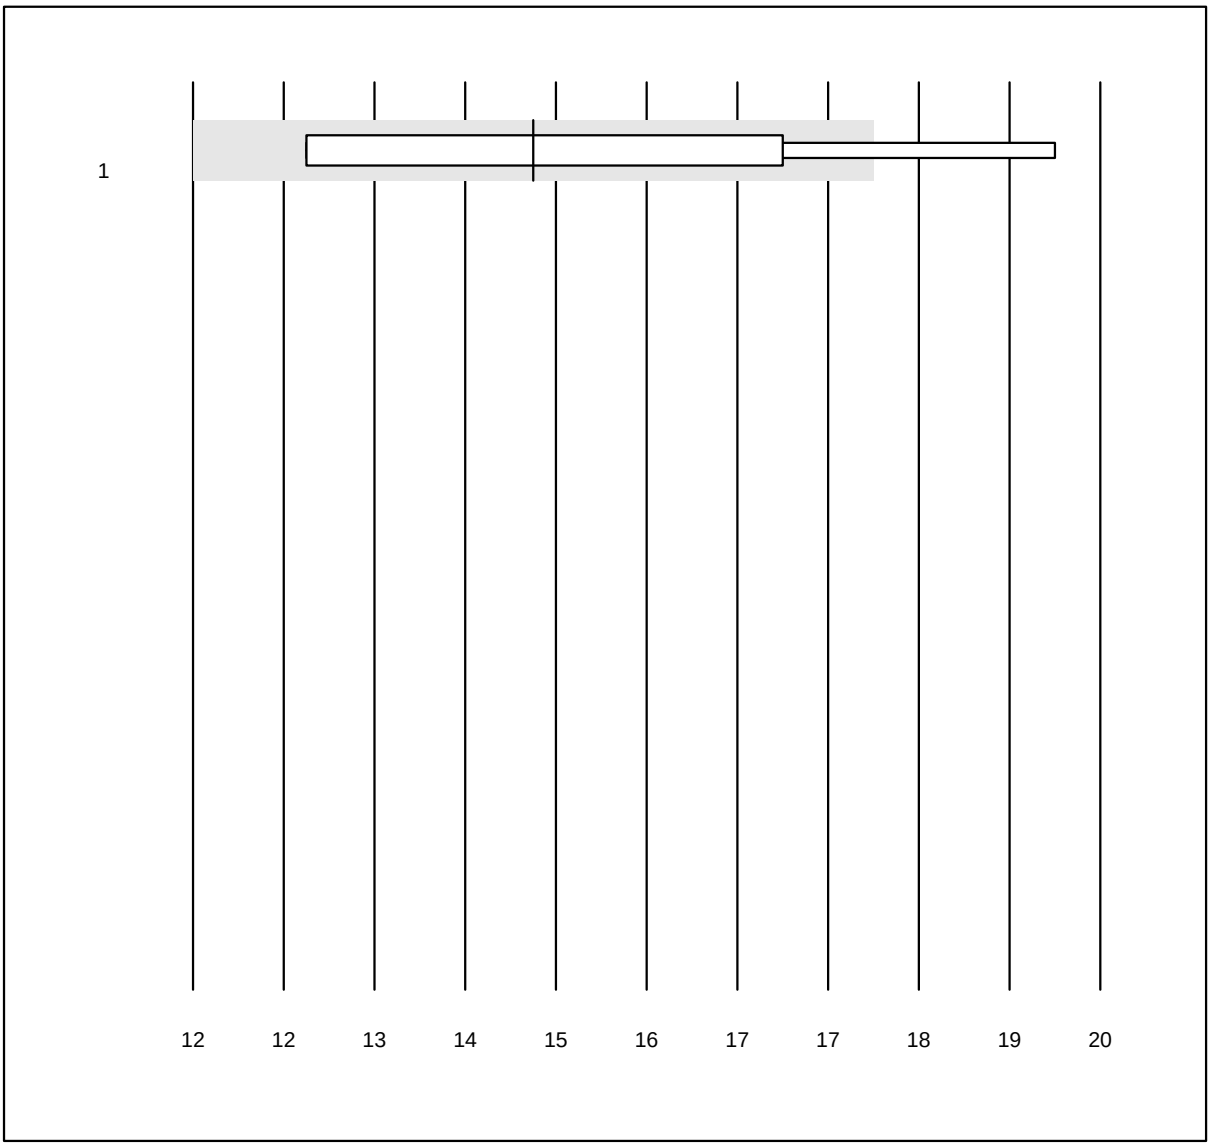


MQ Toleranz: 20%

LDH CSF (U/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	4	100.0	0.0	0.0	15	16.0	a*

Protéine CSF

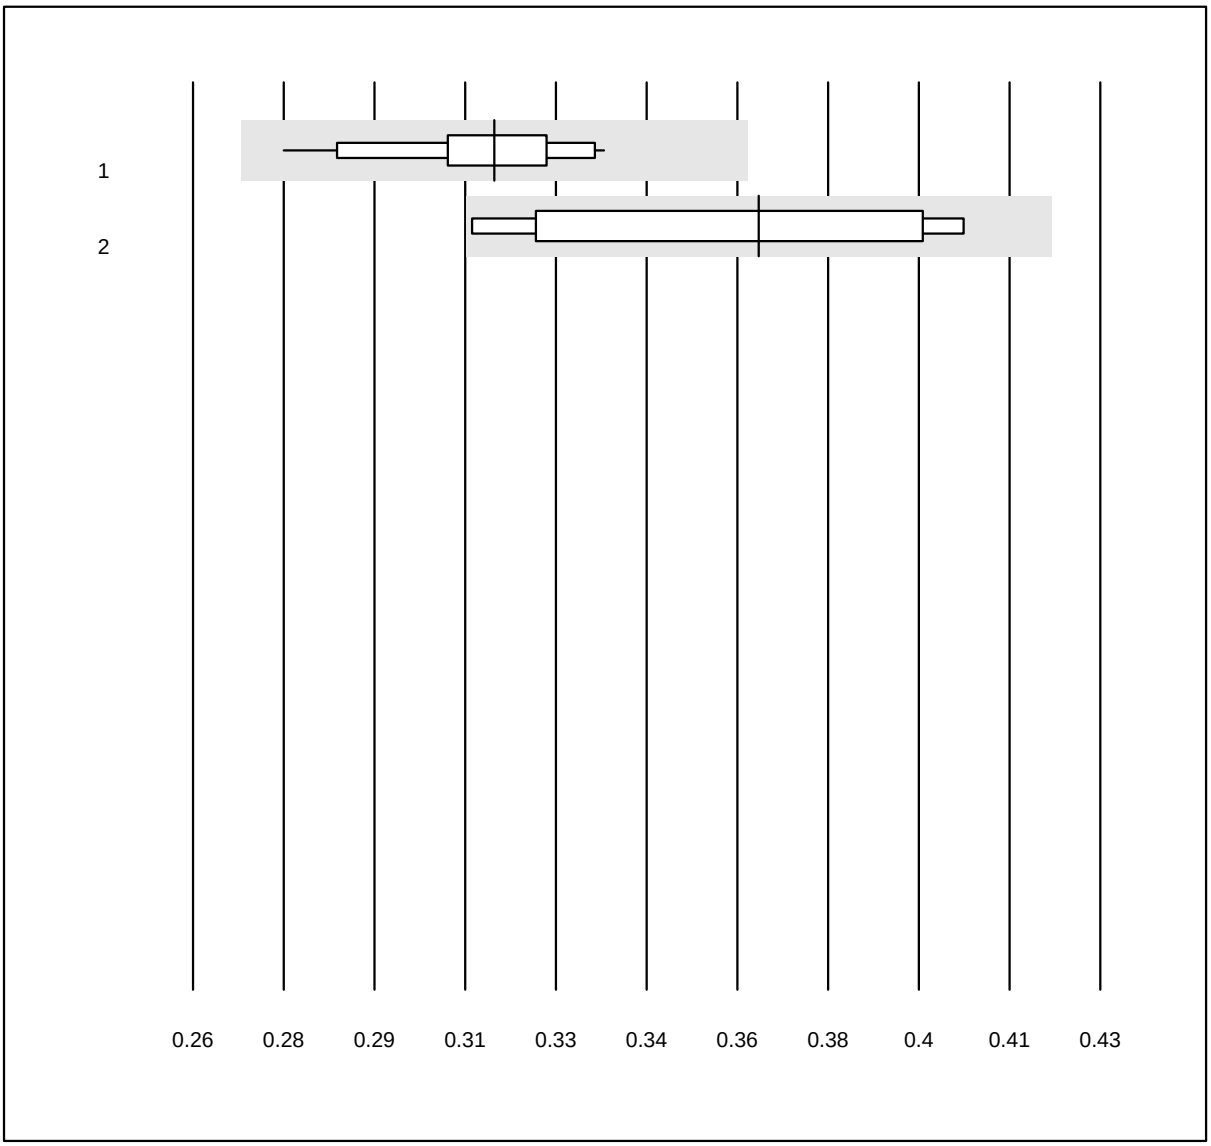


QUALAB Toleranz: 15%

Protéine CSF (g/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	26	100.0	0.0	0.0	0.32	5.0	e
2	Autres méthodes	8	100.0	0.0	0.0	0.37	10.1	e*

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

CDT

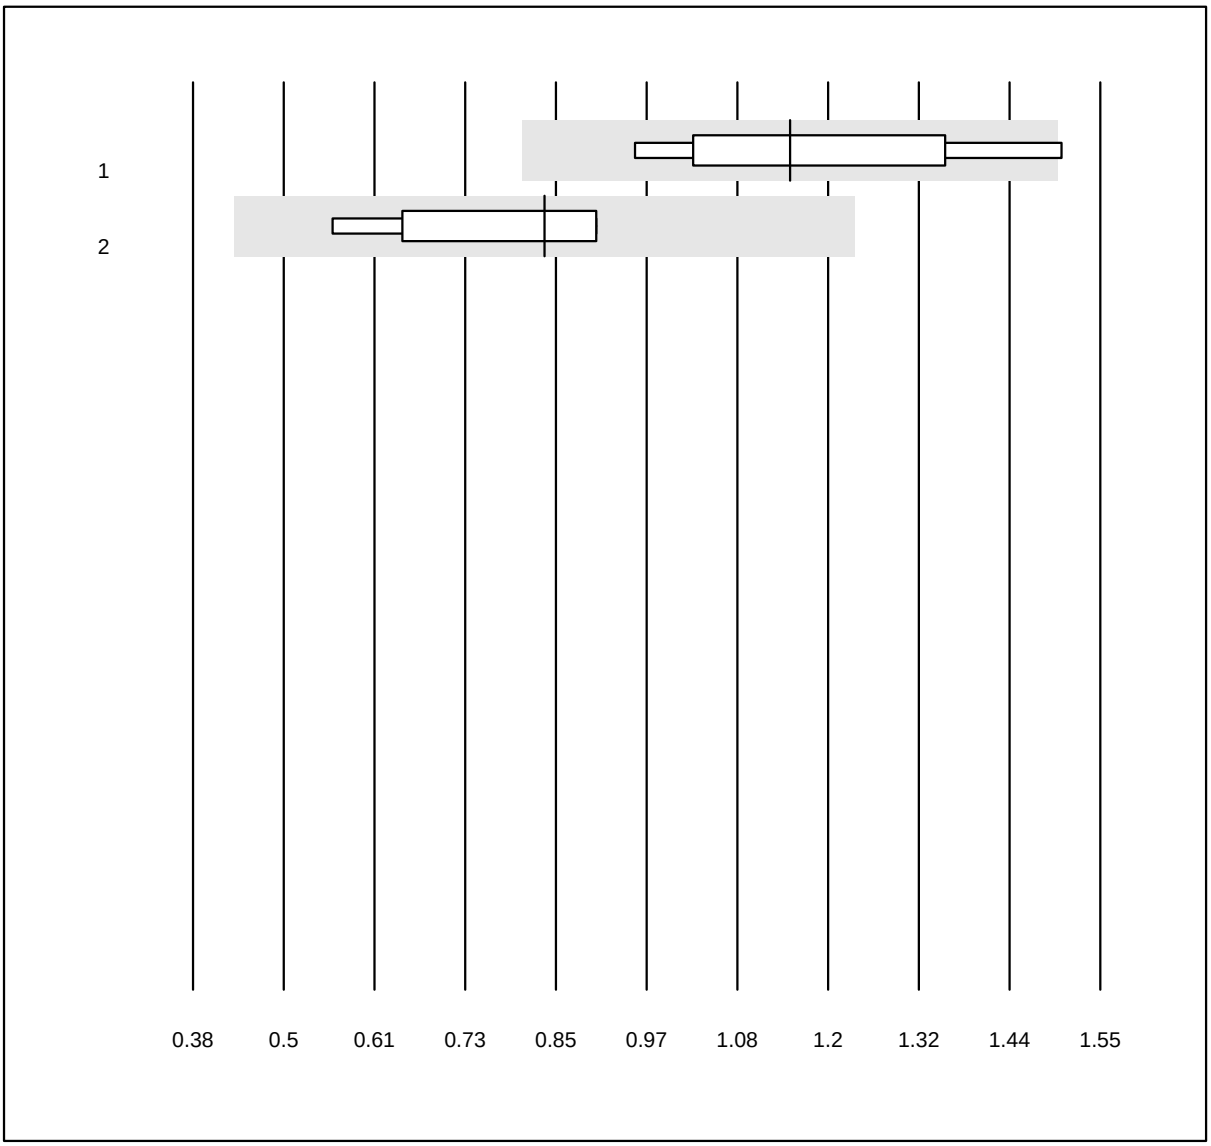


MQ Toleranz: 30%

CDT (%)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Immunoassay	4	100.0	0.0	0.0	1.1	14.5	e*
2	Autres méthodes	5	100.0	0.0	0.0	0.8	17.7	e*

Everolimus

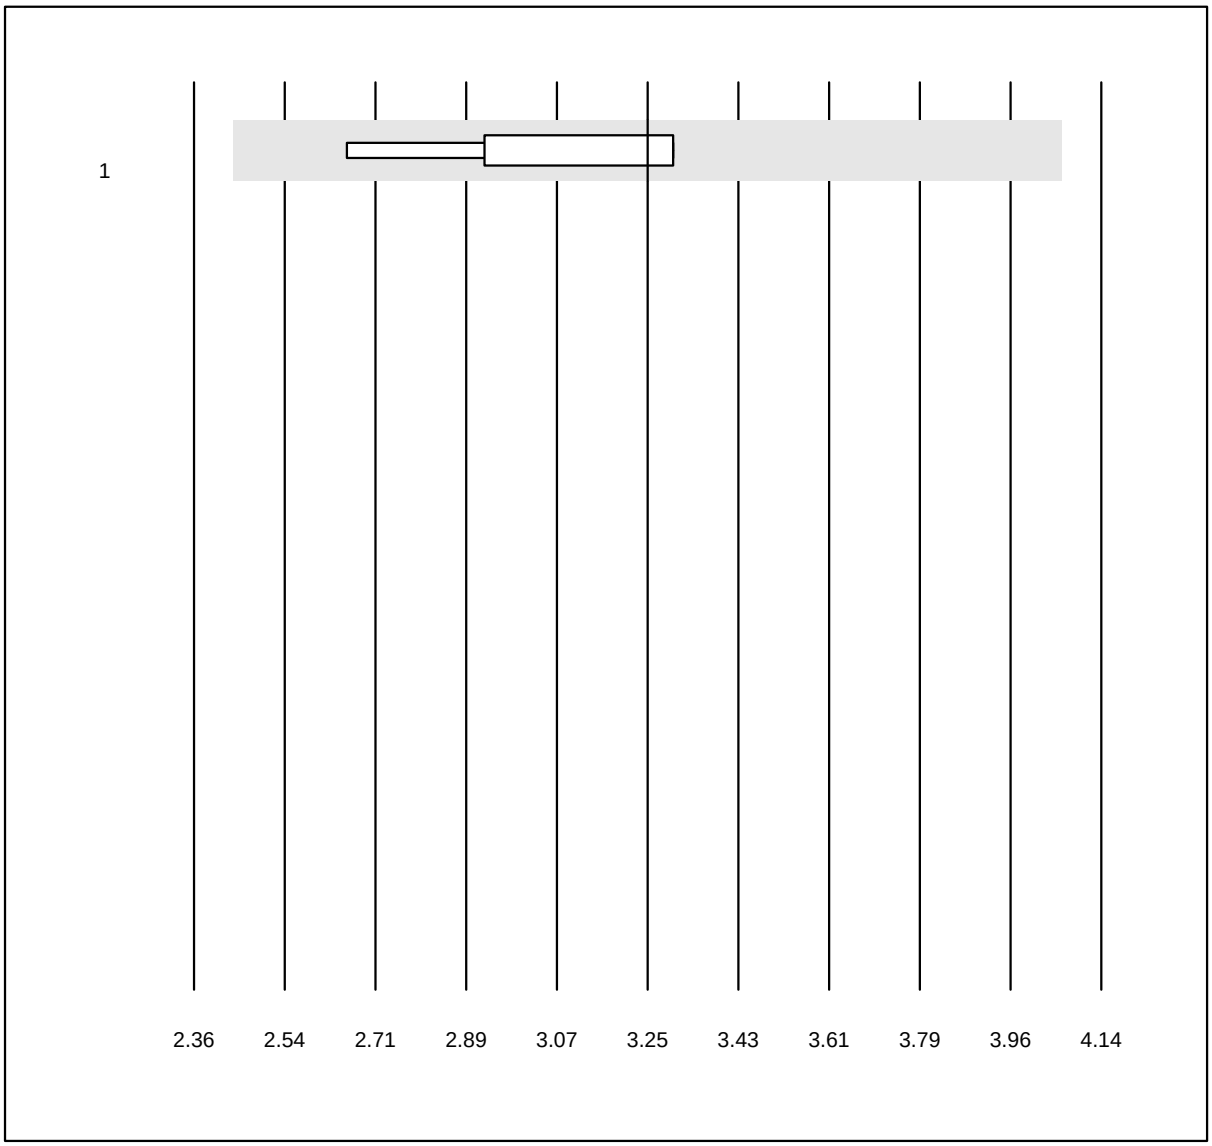


MQ Toleranz: 25%

Everolimus (µg/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	3.3	6.9	e*

Sirolimus

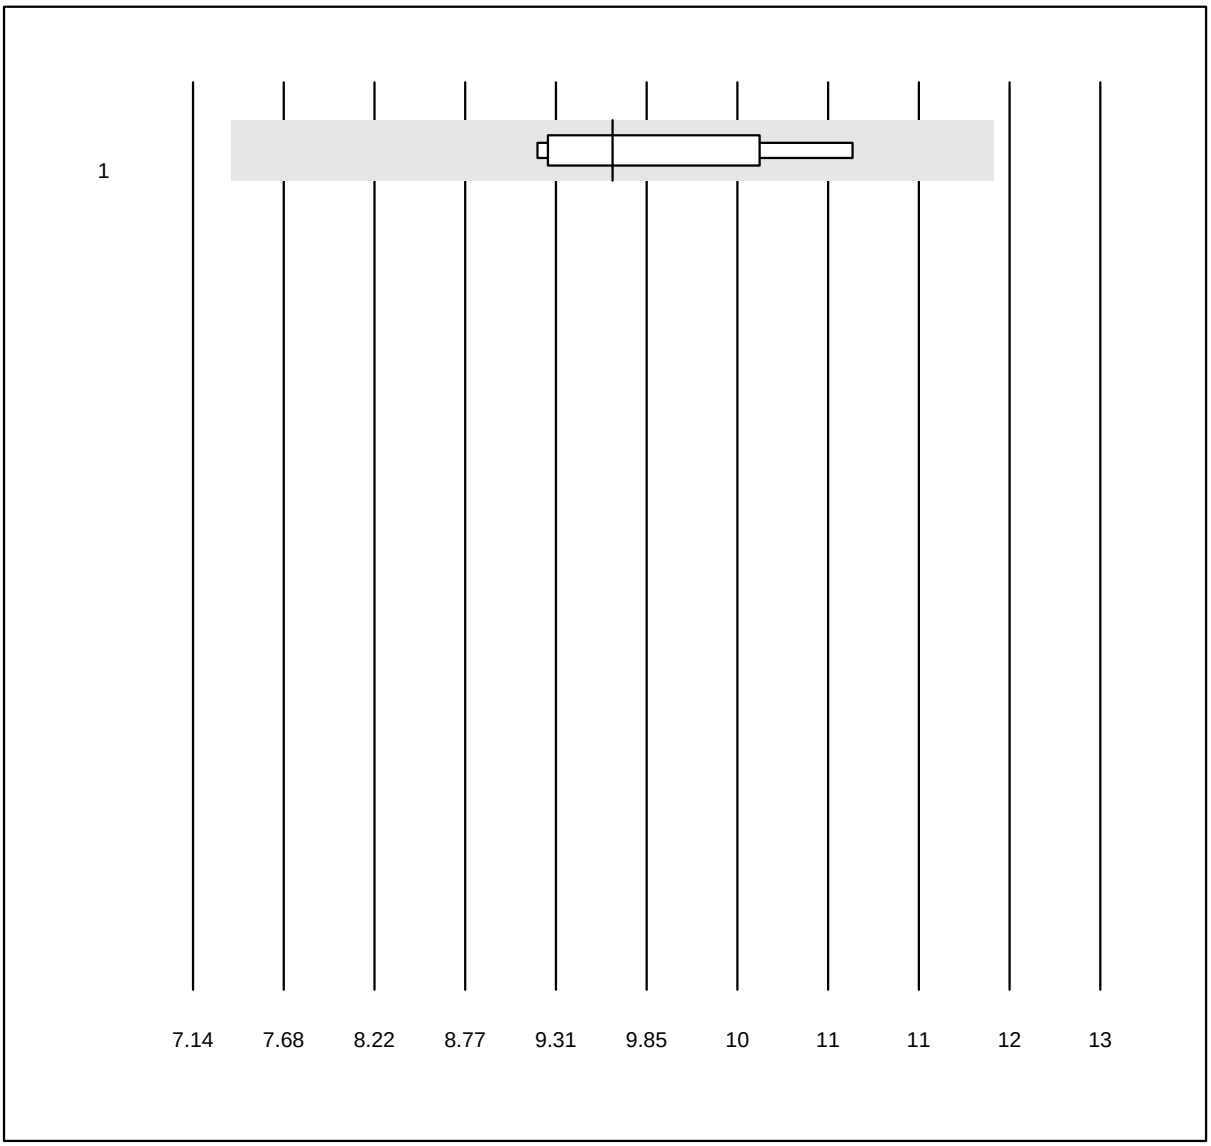


MQ Toleranz: 25%

Sirolimus (µg/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	toutes les méthodes	4	100.0	0.0	0.0	9.8	7.4	e*

Tacrolimus

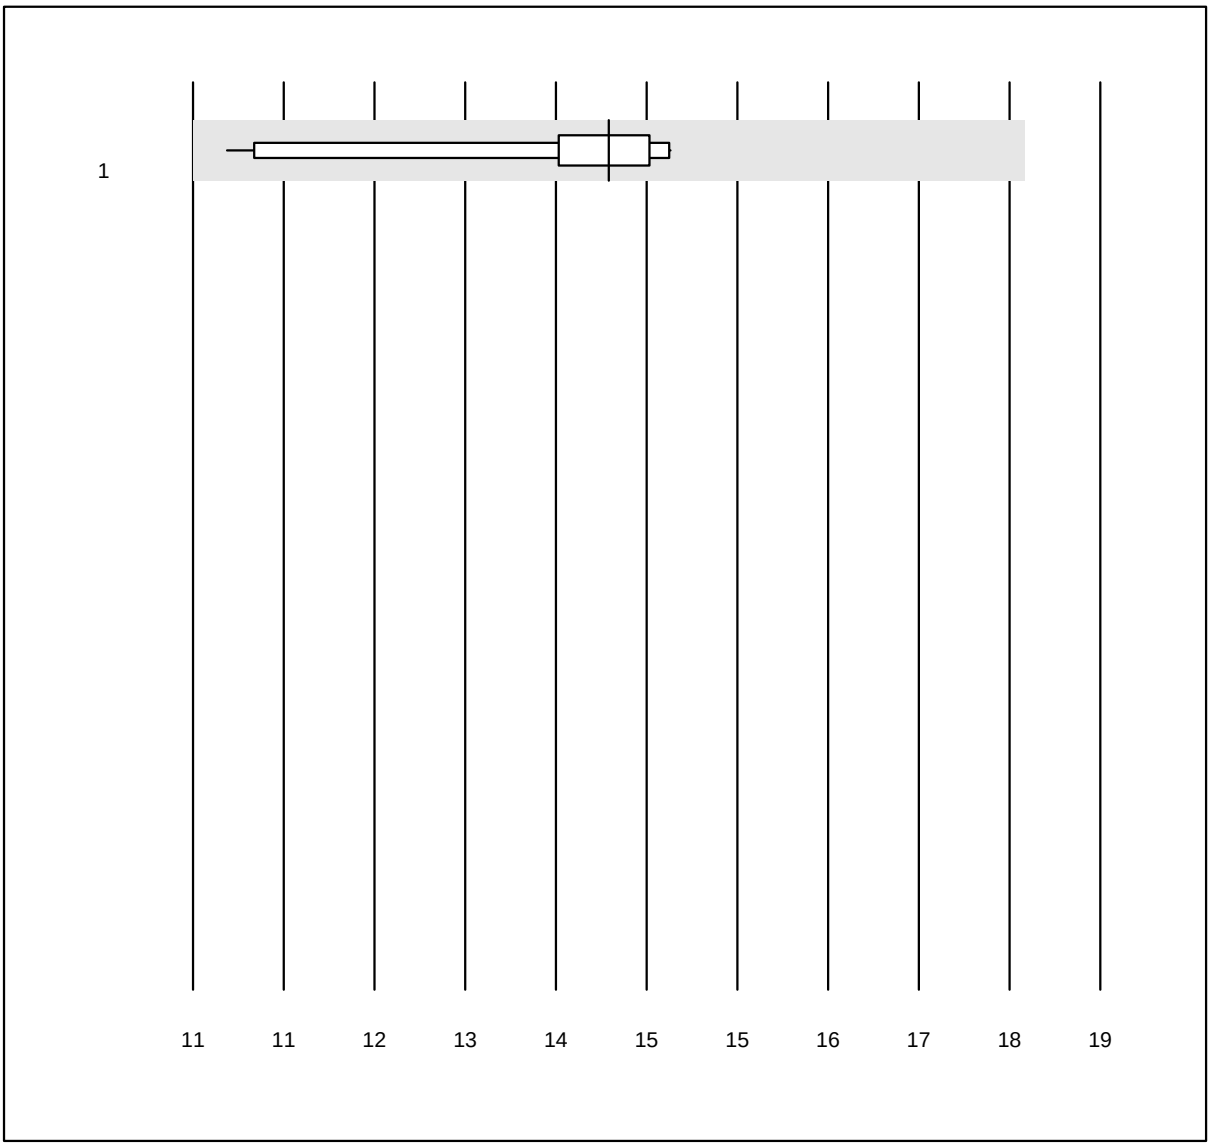


MQ Toleranz: 25%

Tacrolimus (µg/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	toutes les méthodes	10	100.0	0.0	0.0	14.7	8.1	e

Protéine totale E

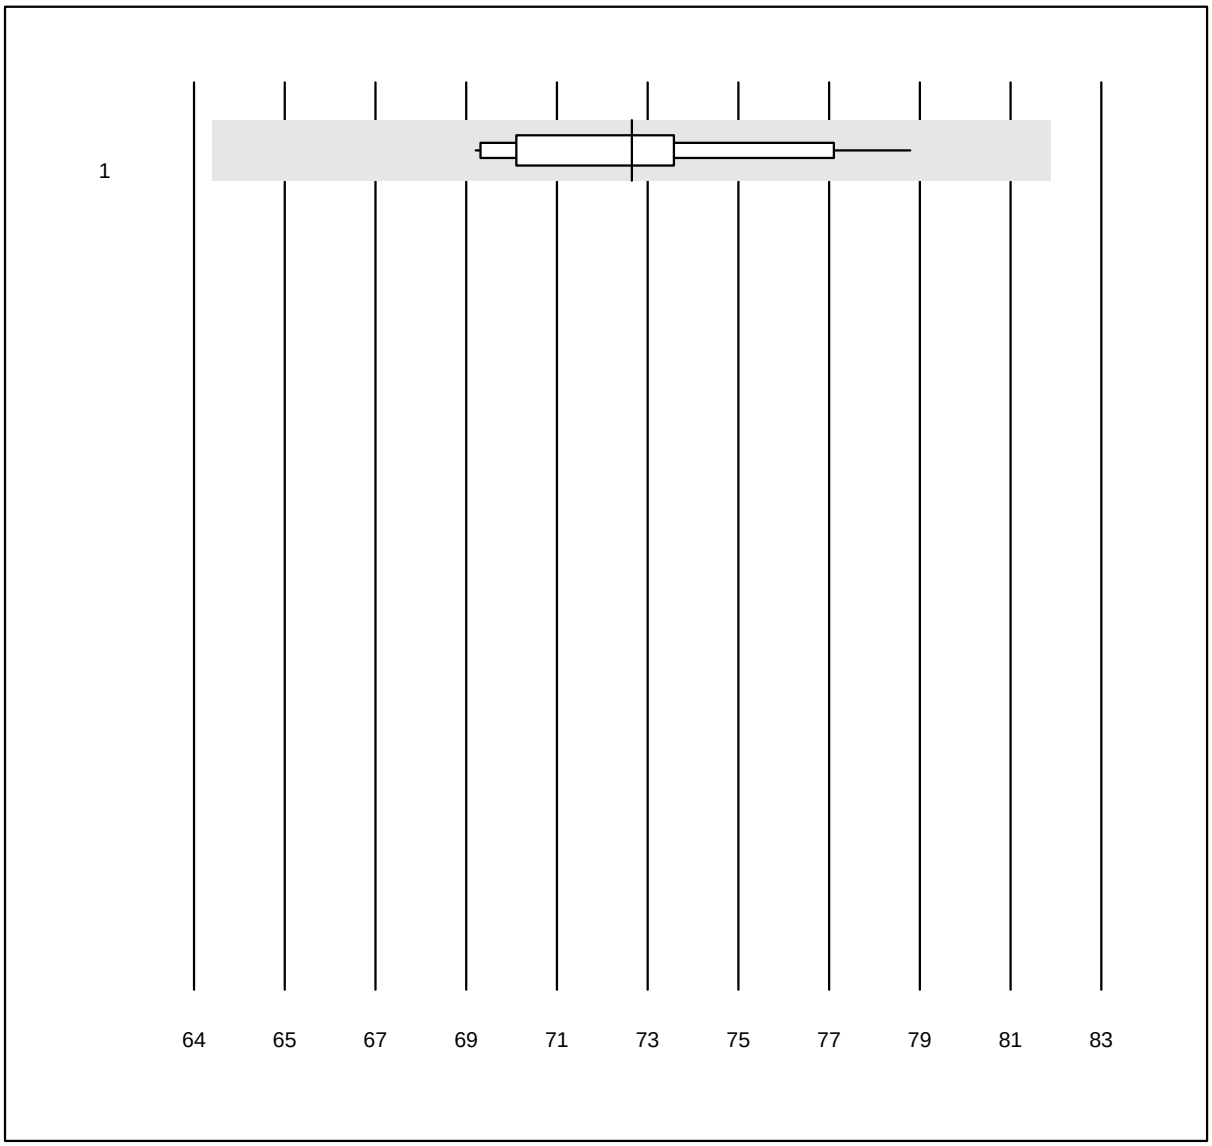


MQ Toleranz: 12%

Protéine totale E (g/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	toutes les méthodes	23	95.7	0.0	4.3	73.2	3.4	e

Albumine E

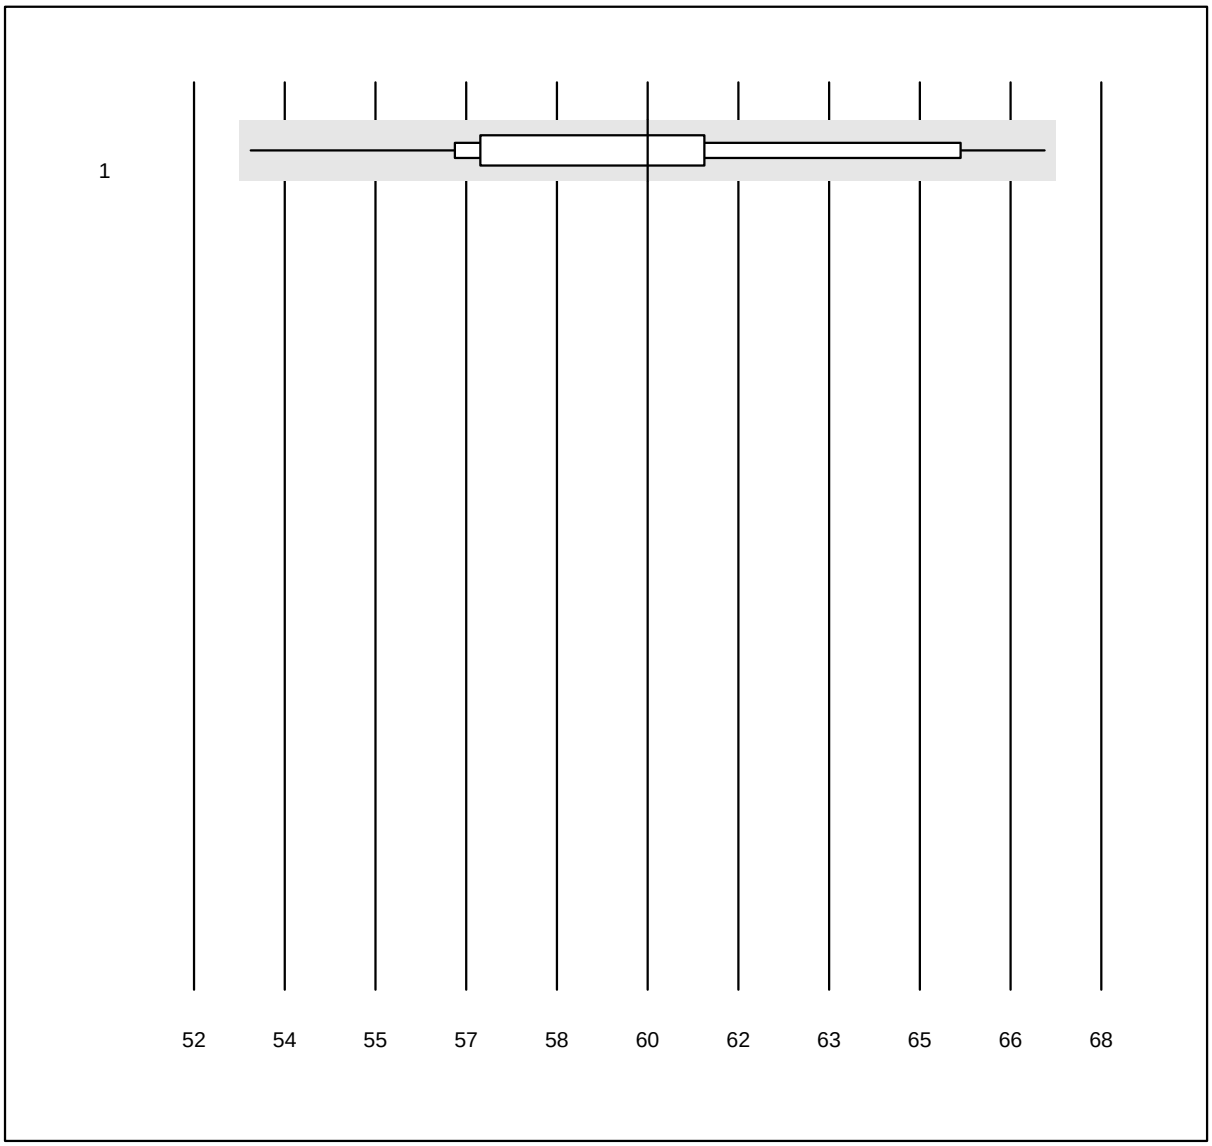


MQ Toleranz: 12%

Albumine E (%)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	électrophorèse	37	100.0	0.0	0.0	60.0	5.8	a

alpha-1-Globuline

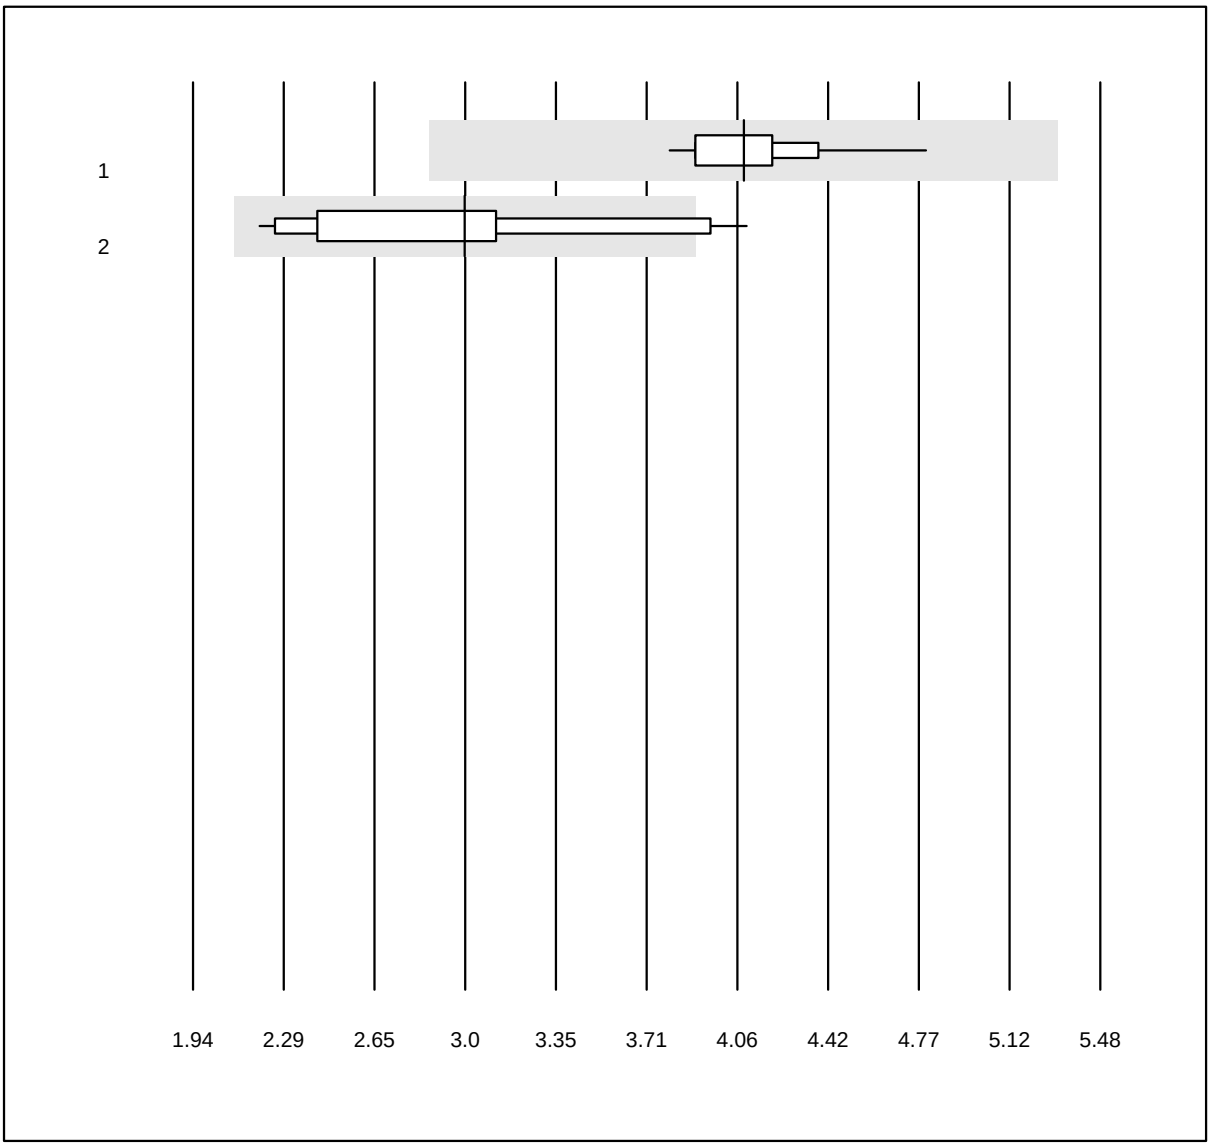


MQ Toleranz: 30%

alpha-1-Globuline (%)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	électrophorèse capillaire	25	100.0	0.0	0.0	4.1	5.3	e
2	électrophorèse	12	91.7	8.3	0.0	3.0	19.8	a*

alpha-2-Globuline

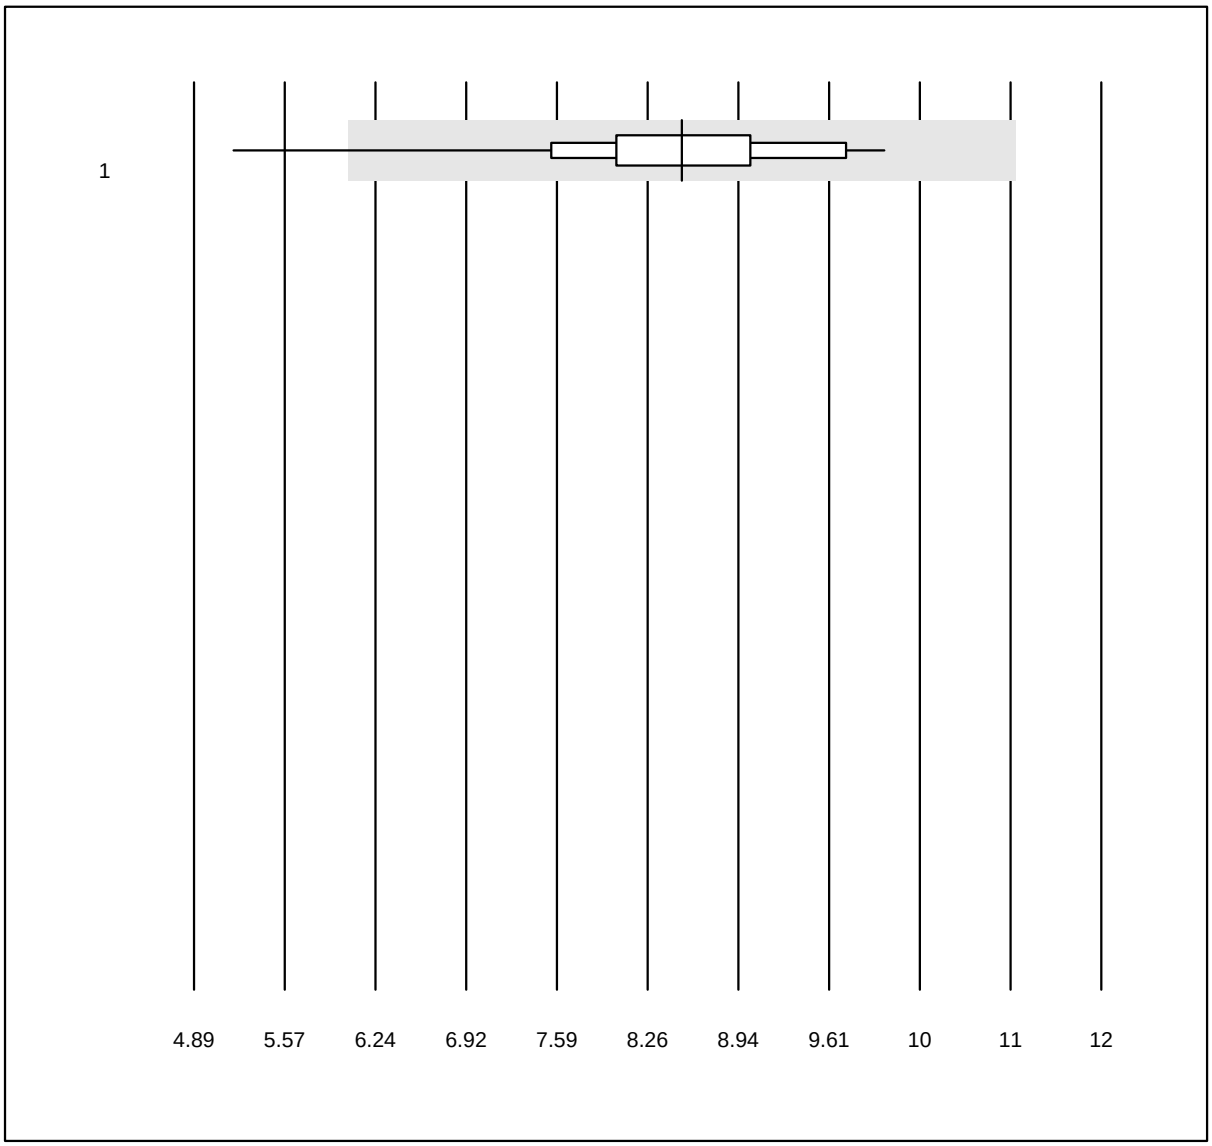


MQ Toleranz: 30%

alpha-2-Globuline (%)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	électrophorèse	37	94.6	2.7	2.7	8.7	11.6	e

beta-Globuline

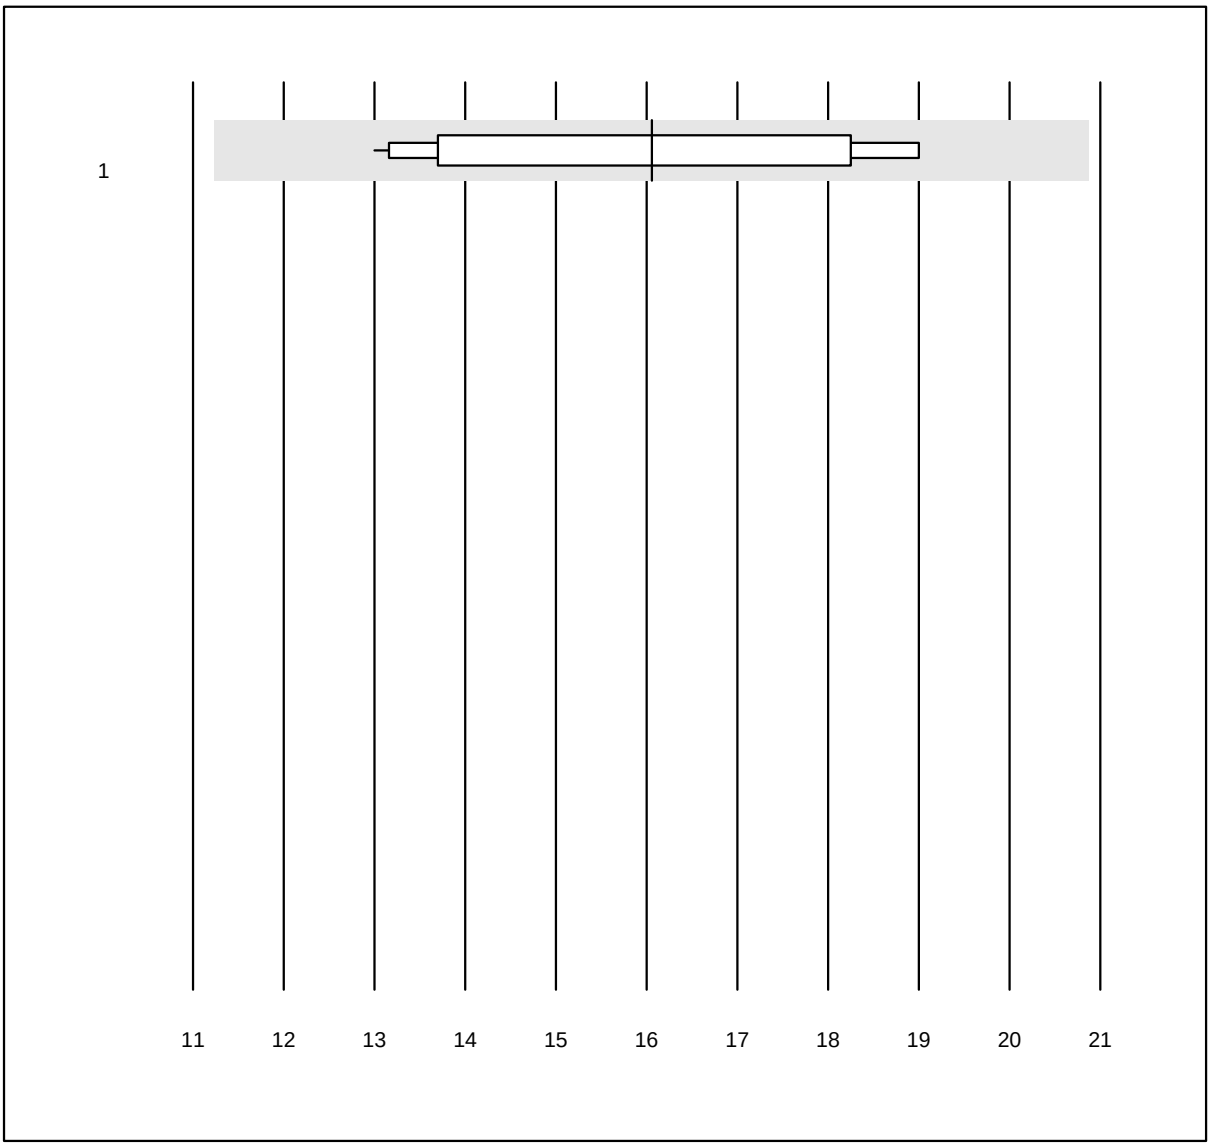


MQ Toleranz: 30%

beta-Globuline (%)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	électrophorèse	17	100.0	0.0	0.0	16.1	14.4	e

Béta-1-globuline

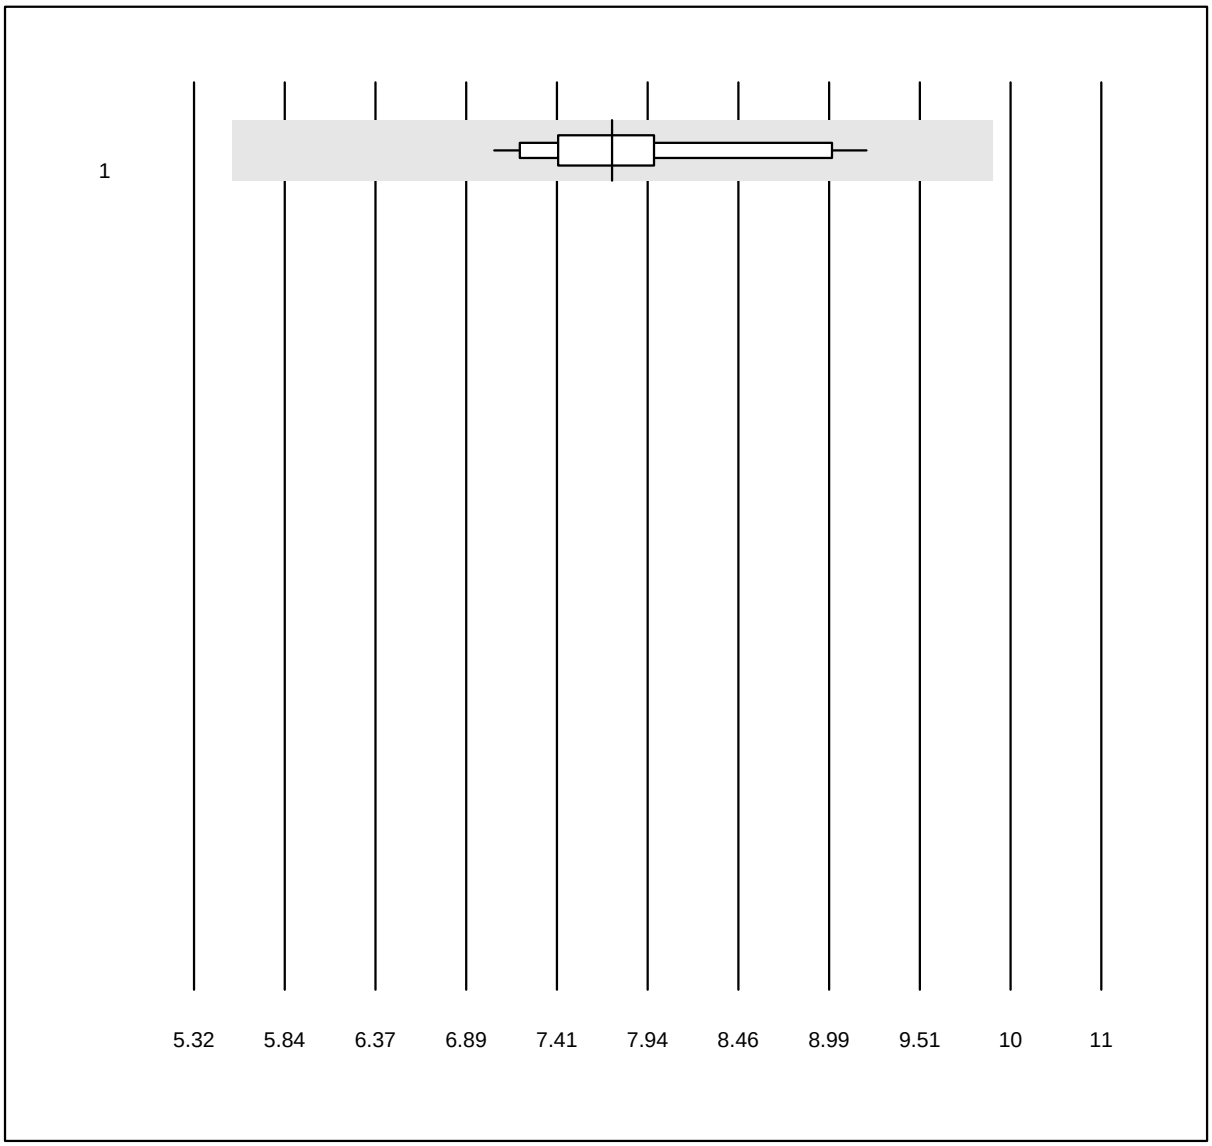


MQ Toleranz: 30%

Béta-1-globuline (%)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	électrophorèse	18	94.4	0.0	5.6	7.9	7.7	e

Béta-2-globuline

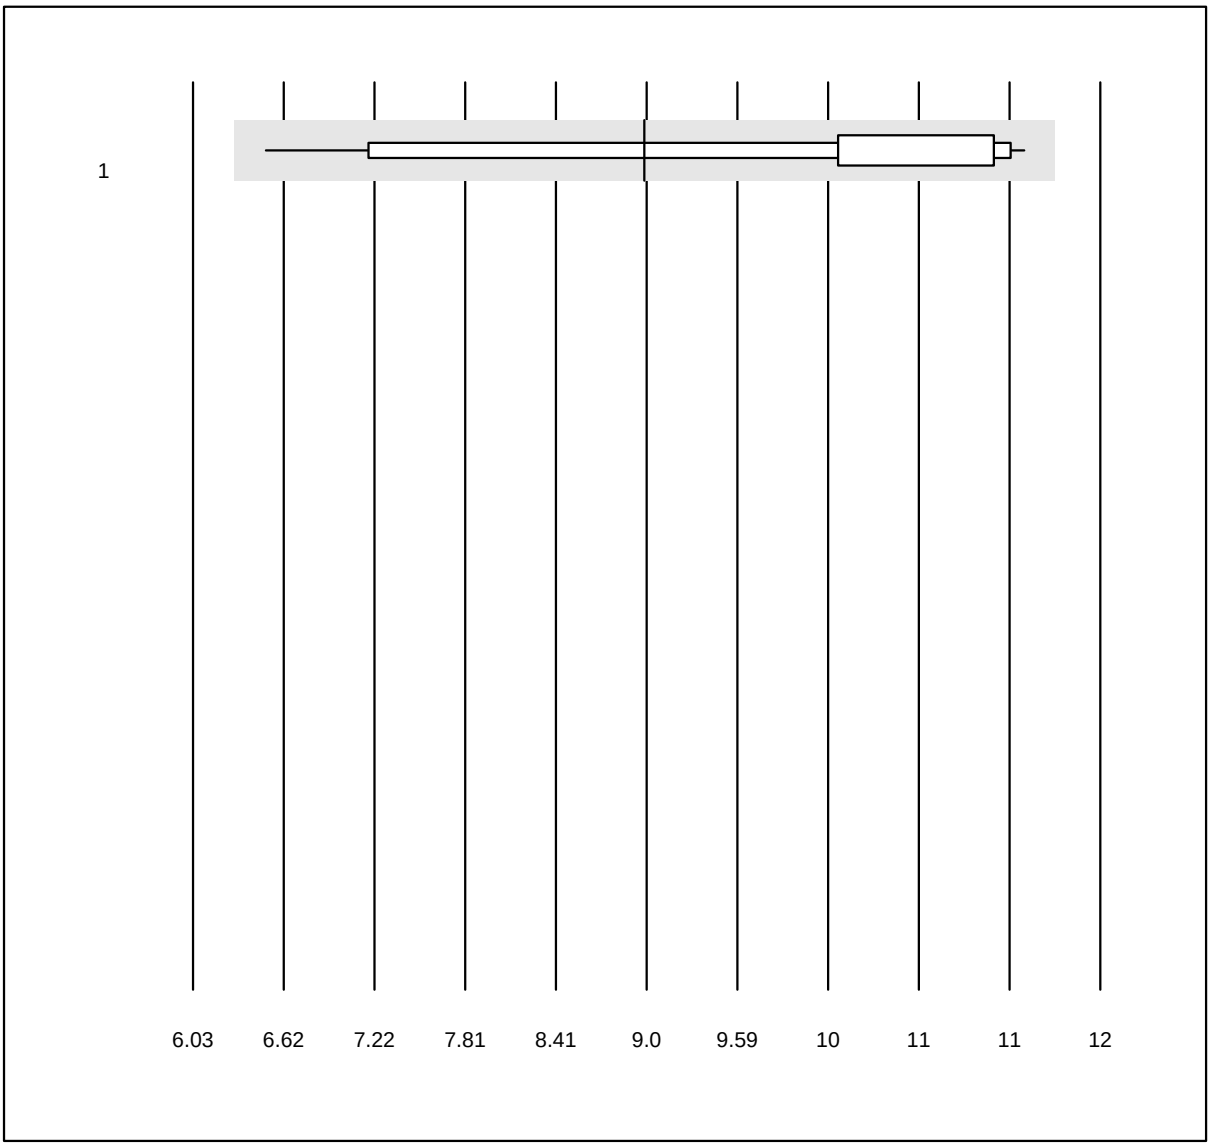


MQ Toleranz: 30%

Béta-2-globuline (%)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	électrophorèse	18	100.0	0.0	0.0	9.0	13.1	a

Beta-Globuline+P

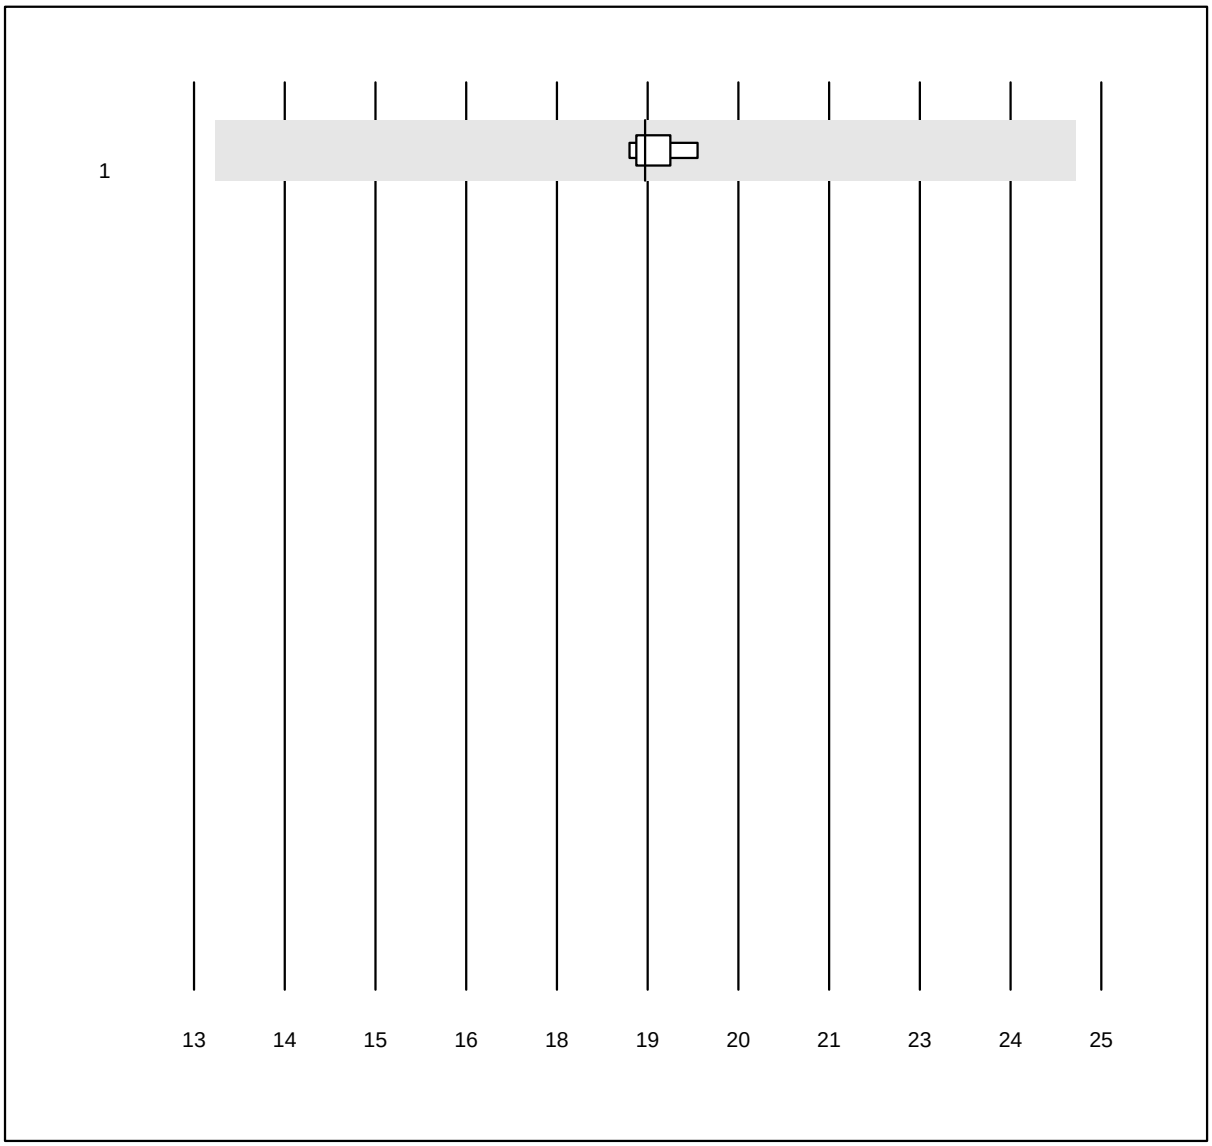


MQ Toleranz: 30%

Beta-Globuline+P (%)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	électrophorèse	5	100.0	0.0	0.0	19	1.5	e

gamma-Globuline

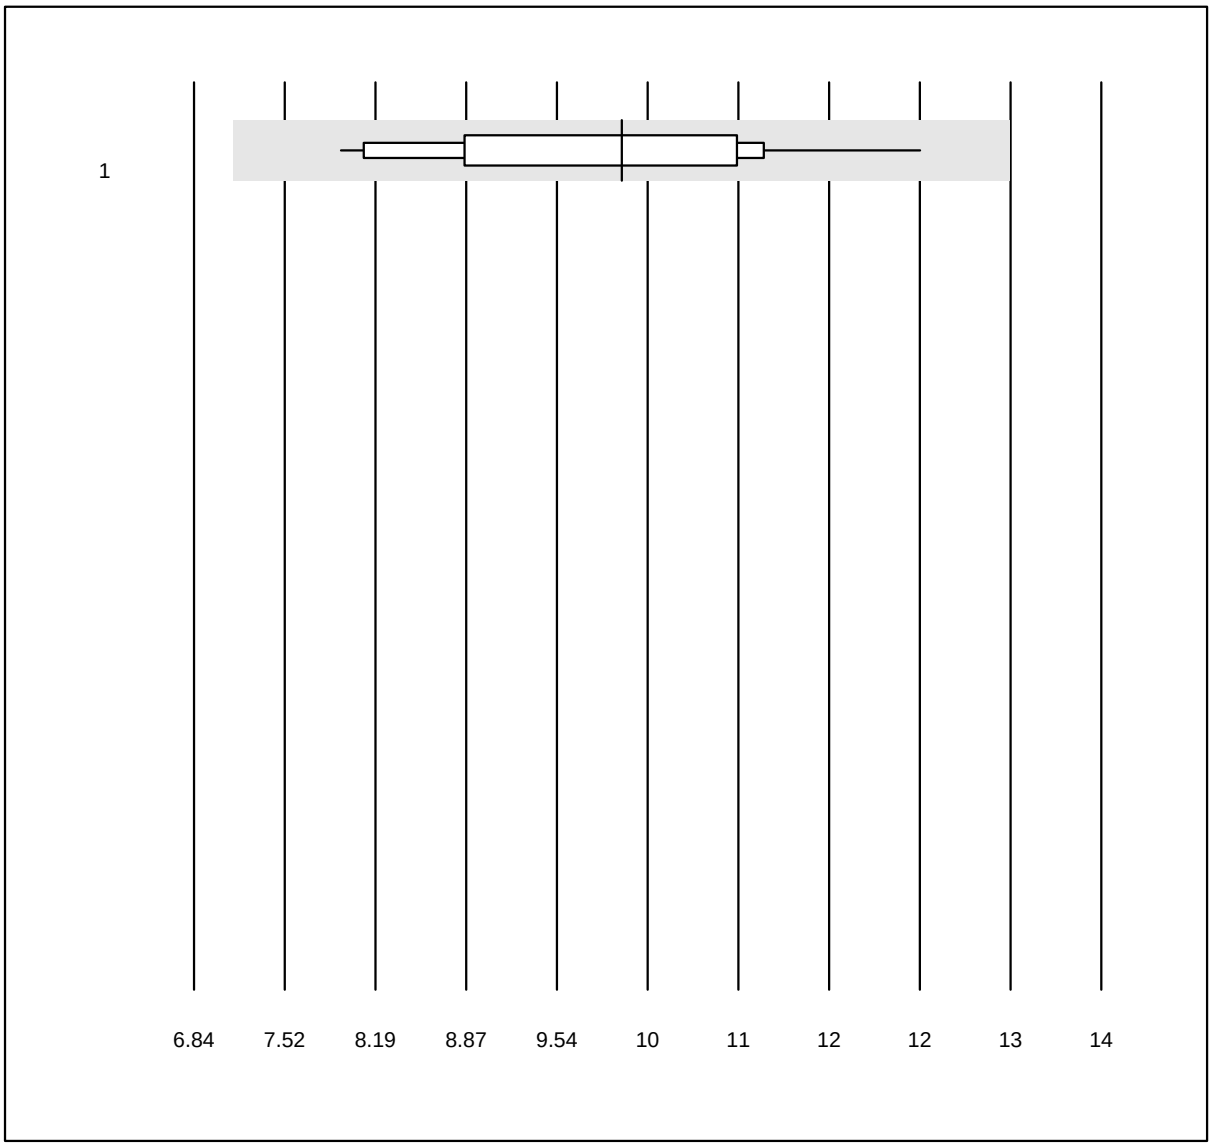


MQ Toleranz: 30%

gamma-Globuline (%)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	électrophorèse	18	100.0	0.0	0.0	10.2	12.4	e

Gamma-Globuline+P

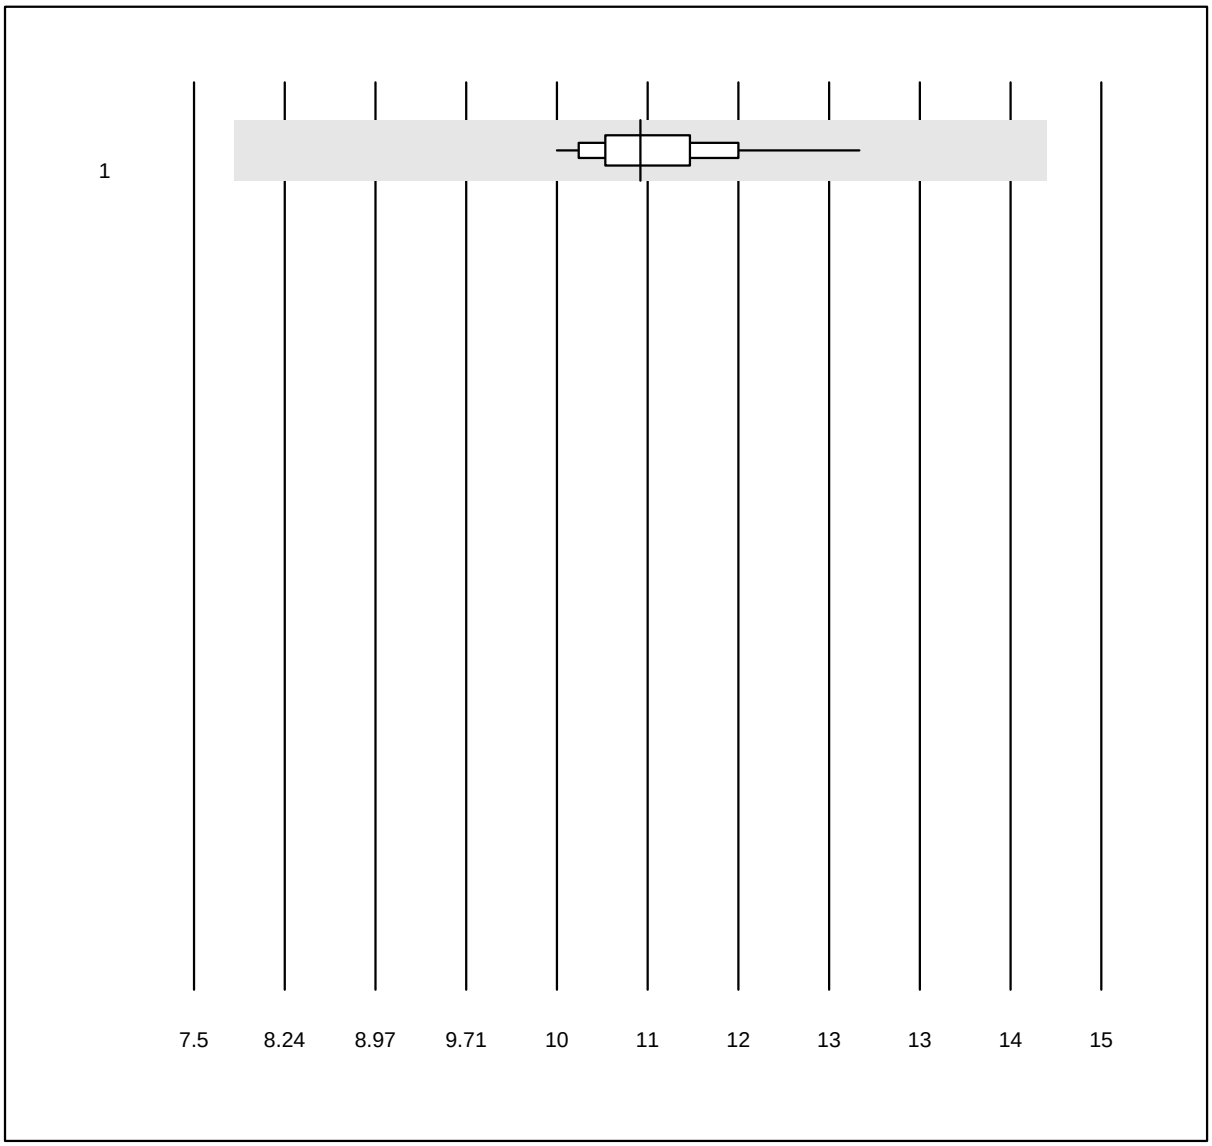


MQ Toleranz: 30%

Gamma-Globuline+P (%)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	électrophorèse	19	100.0	0.0	0.0	11.2	5.0	e

Folates érythrocytaires

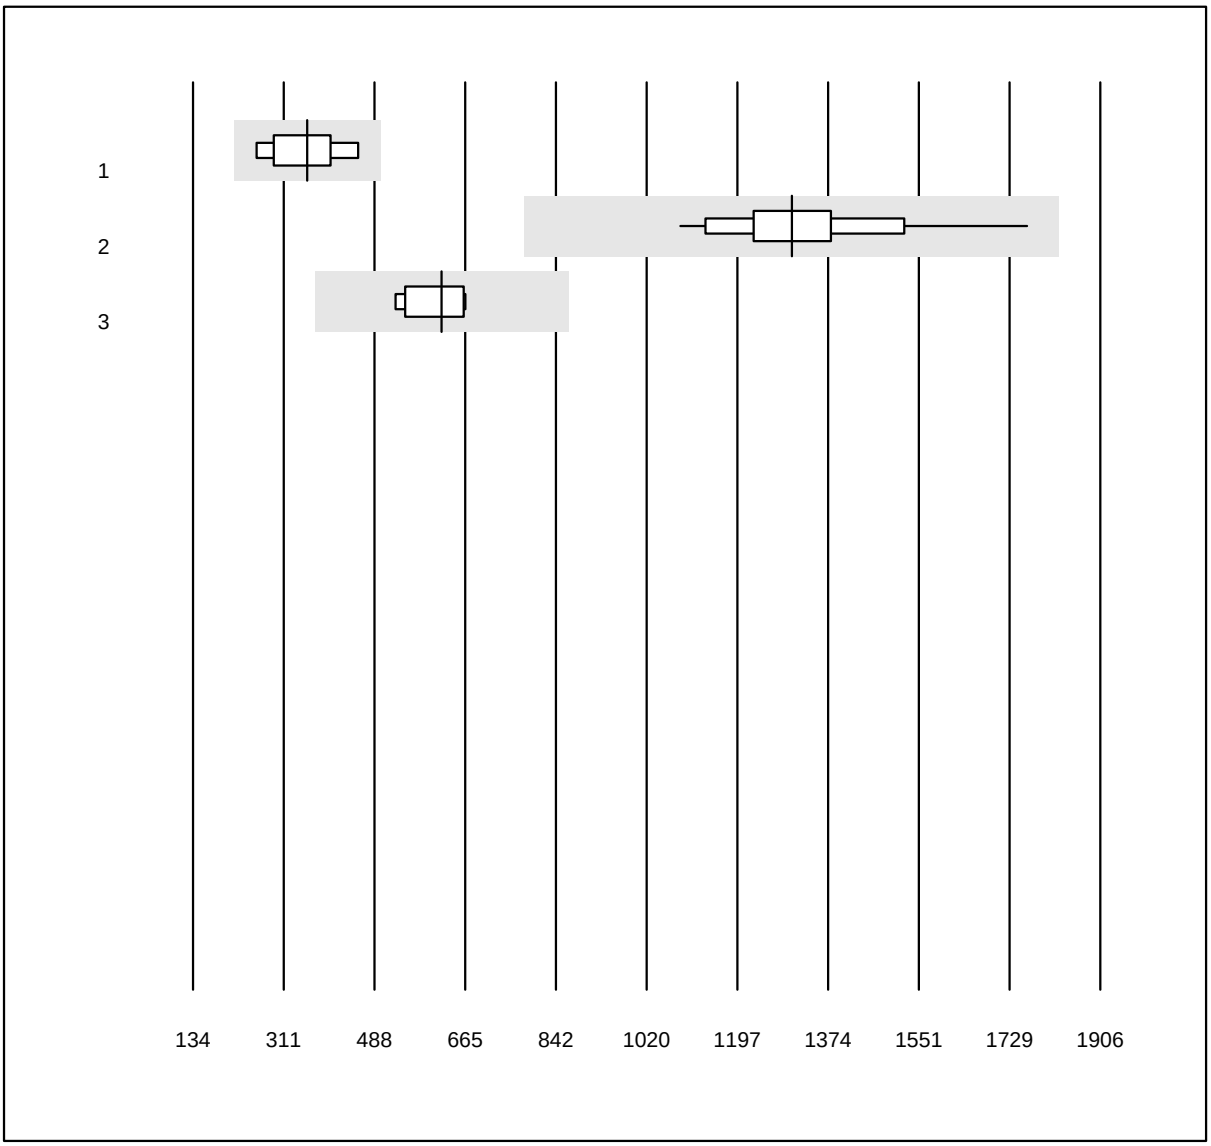


MQ Toleranz: 40%

Folates érythrocytaires
(nmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	8	100.0	0.0	0.0	357	19.4	a*
2	Roche	31	100.0	0.0	0.0	1304	10.9	e
3	Siemens	6	100.0	0.0	0.0	620	9.2	e

3 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Gallensäure

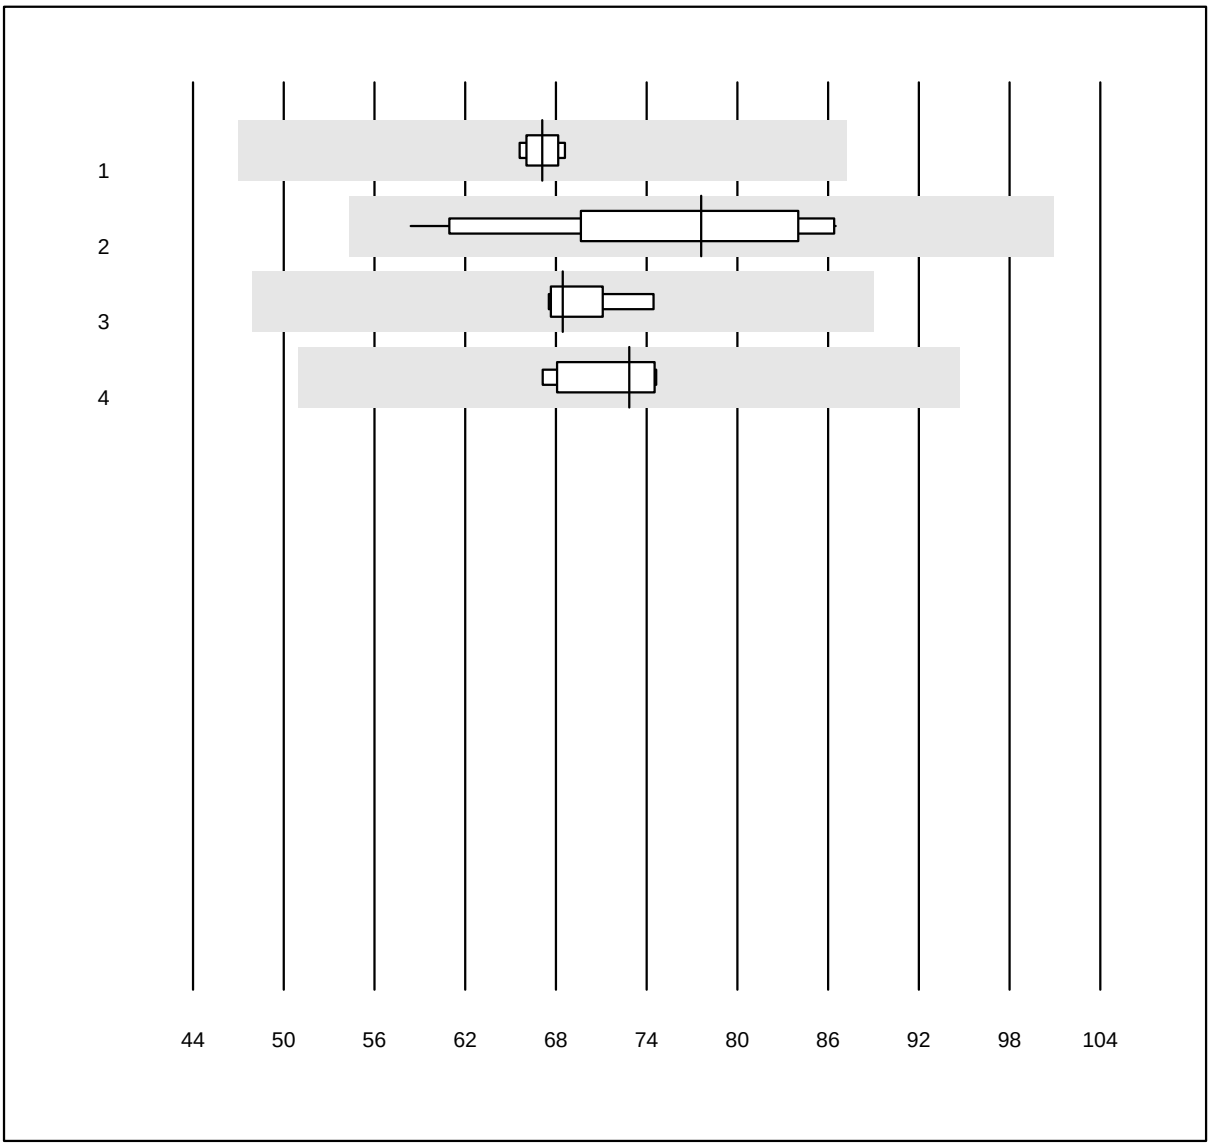


MQ Toleranz: 30%

Gallensäure (µmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	4	100.0	0.0	0.0	67.1	1.6	e
2	Roche	14	100.0	0.0	0.0	77.6	11.4	e
3	Siemens	6	100.0	0.0	0.0	68.5	3.3	e
4	Autres méthodes	6	100.0	0.0	0.0	72.8	4.5	e

Troponine I Triage

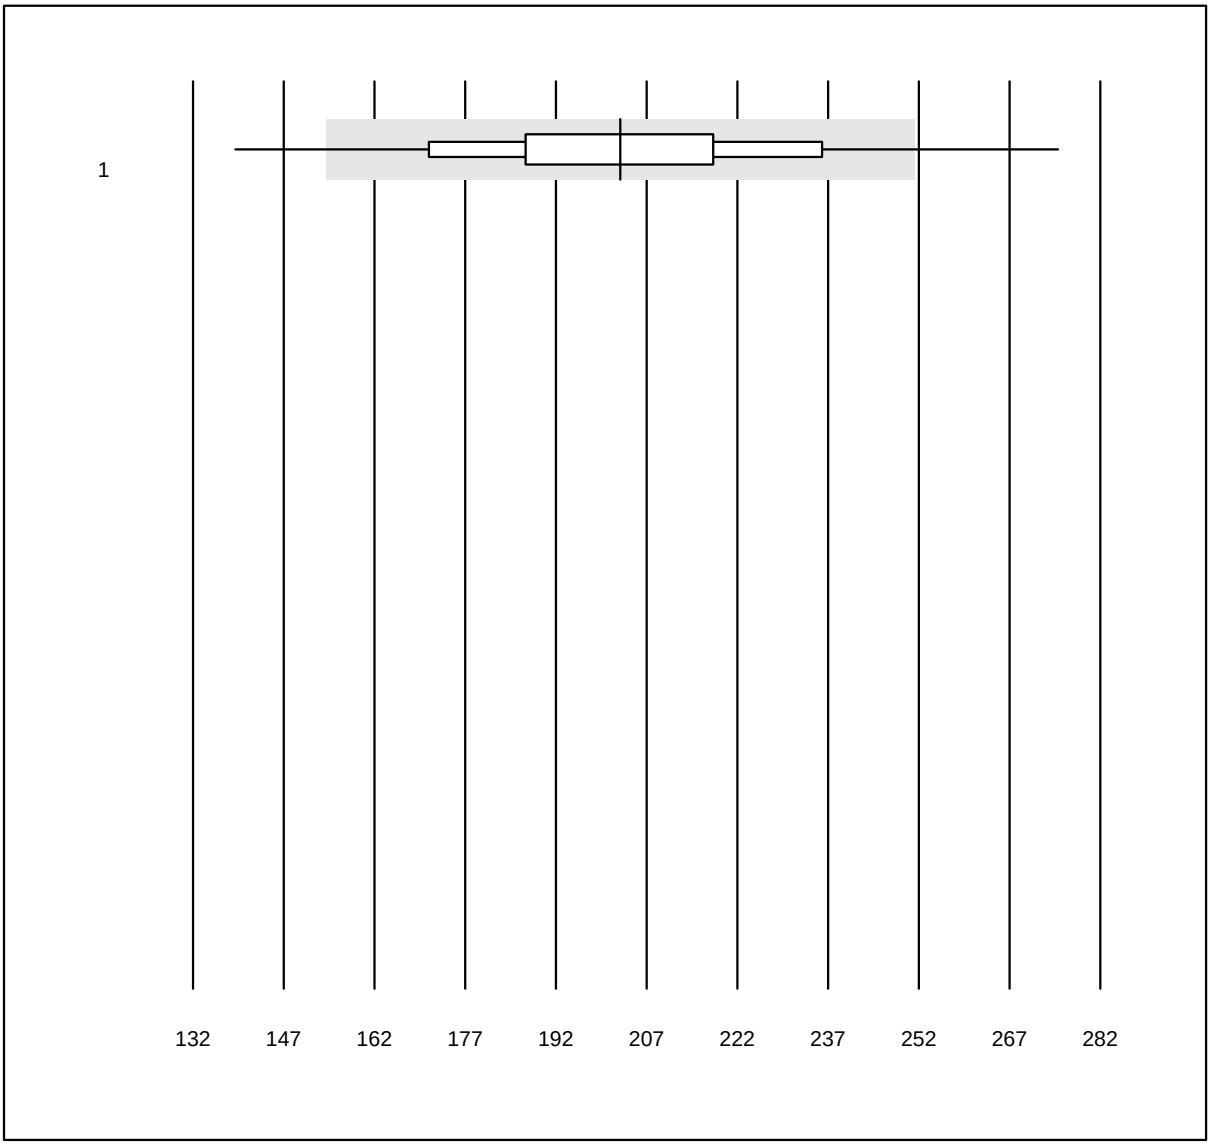


QUALAB Toleranz: 24%

Troponine I Triage (ng/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Triage high sensitive	632	92.1	6.5	1.4	202.64	12.5	e

NT-pro BNP

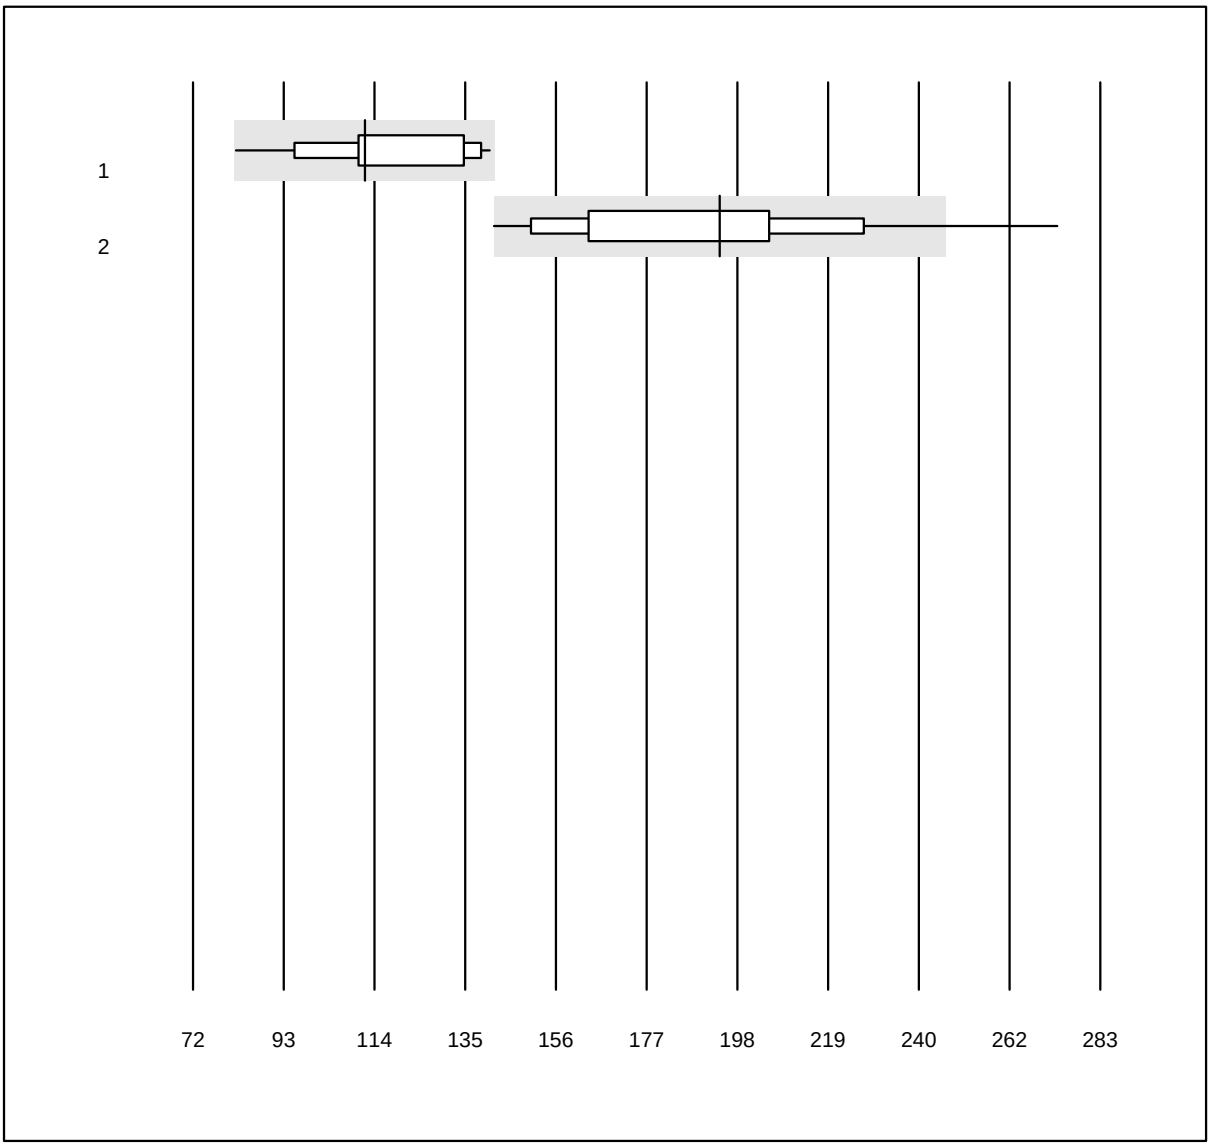


QUALAB Toleranz: 27%

NT-pro BNP (ng/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Triage (Lot-Gen 1)	73	100.0	0.0	0.0	112	13.2	a
2	Triage	297	91.6	4.4	4.0	195	16.3	a

BNP

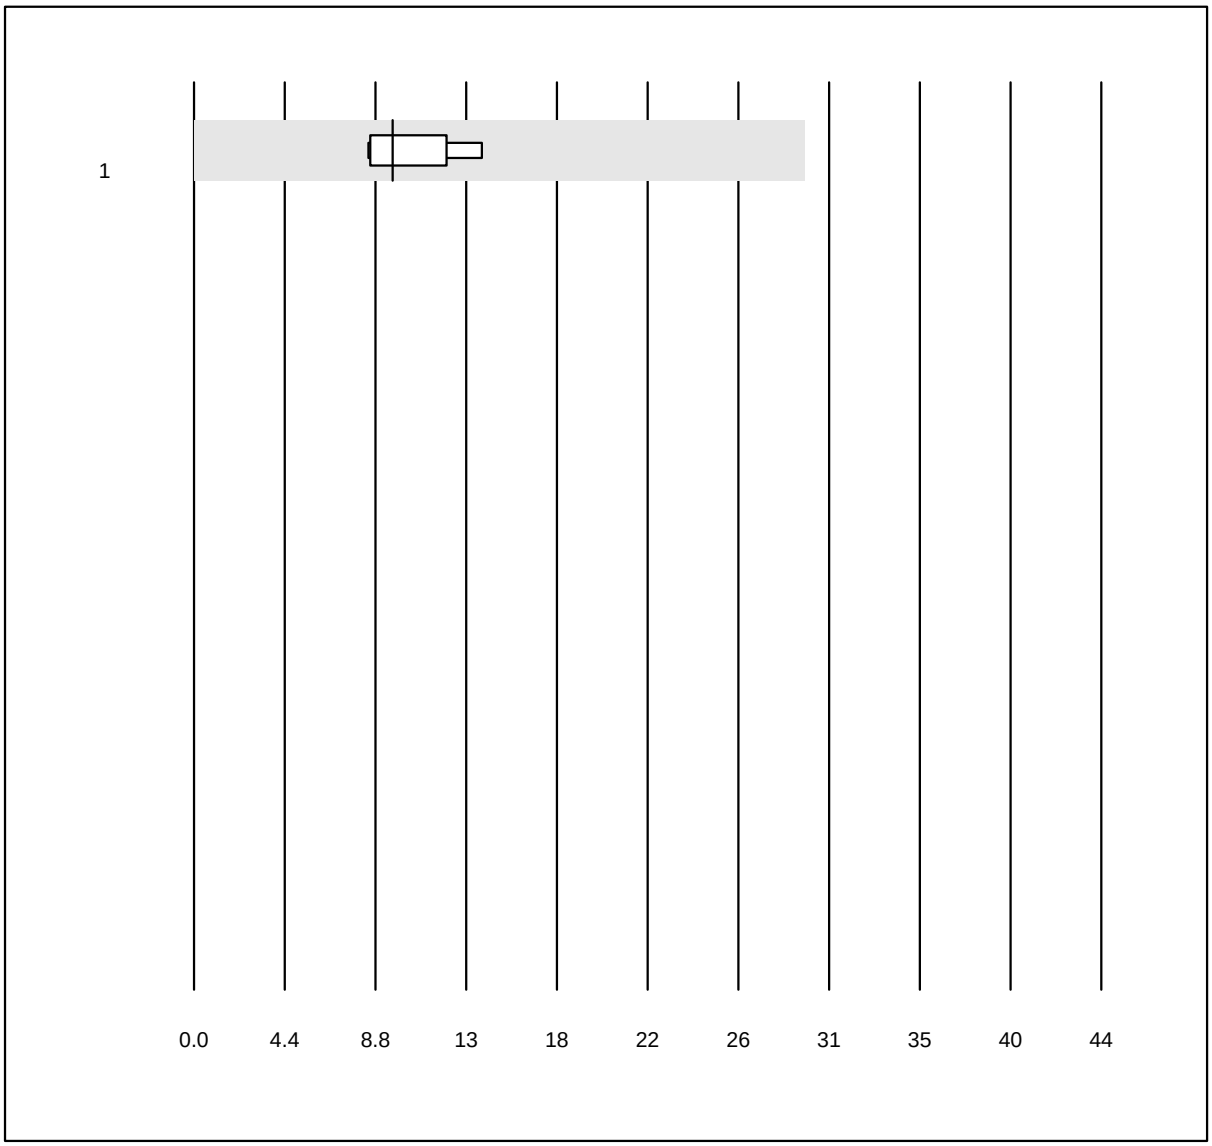


QUALAB Toleranz: 27%
(< 75.0: +/- 20.0 ng/l)

BNP (ng/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Triage	5	100.0	0.0	0.0	9.6	20.4	e

Vitamine D 25 (OH)

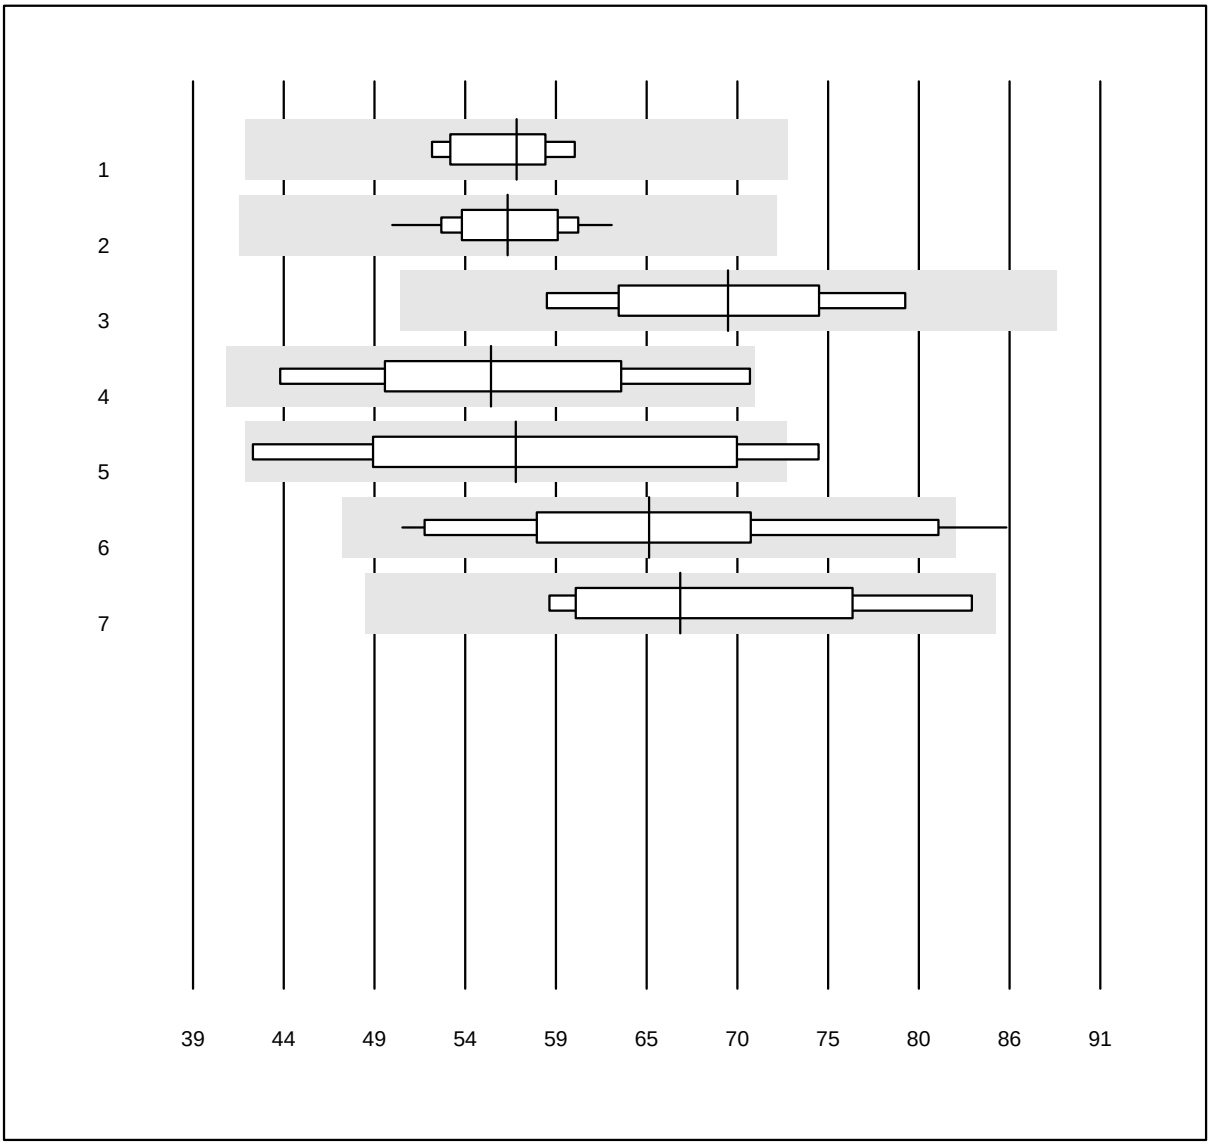


QUALAB Toleranz: 27%

Vitamine D 25 (OH) (nmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	6	100.0	0.0	0.0	57.5	5.0	e
2	Roche	27	100.0	0.0	0.0	57.0	5.6	e
3	Siemens	7	100.0	0.0	0.0	69.7	9.3	e*
4	VIDAS	4	100.0	0.0	0.0	56.1	13.0	e*
5	AFIAS	10	80.0	10.0	10.0	57.5	19.4	a*
6	RapidReader Cube Reader	13	92.3	7.7	0.0	65.1	14.2	e*
7	Autres méthodes	5	100.0	0.0	0.0	66.9	12.4	e*

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Vitamin D 1,25-(OH)2

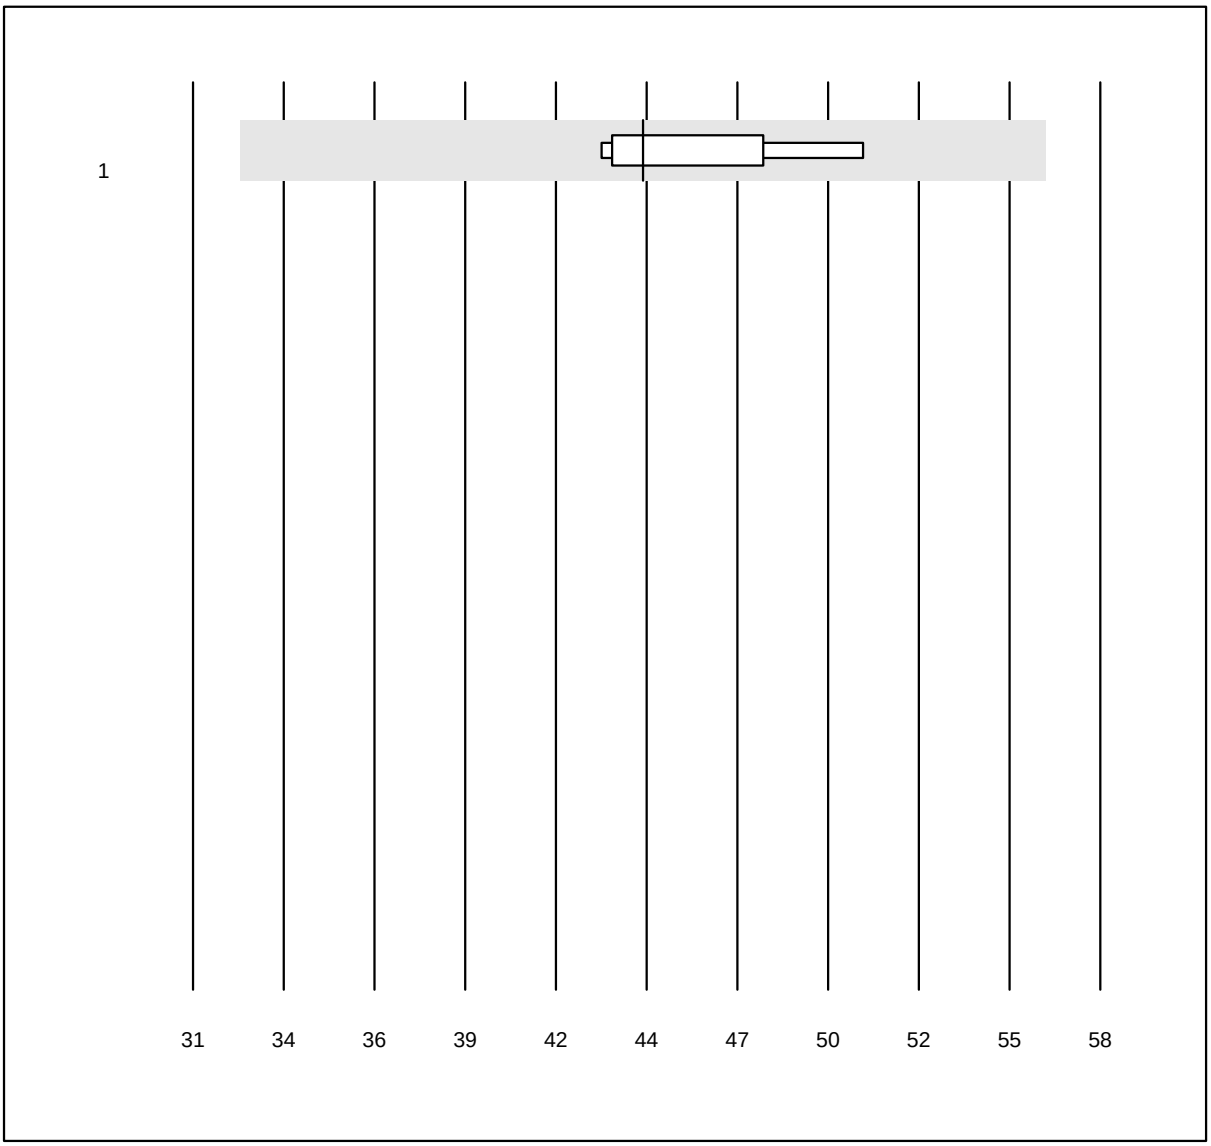


MQ Toleranz: 27%

Vitamin D 1,25-(OH)2 (ng/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	44.4	5.6	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

AMH

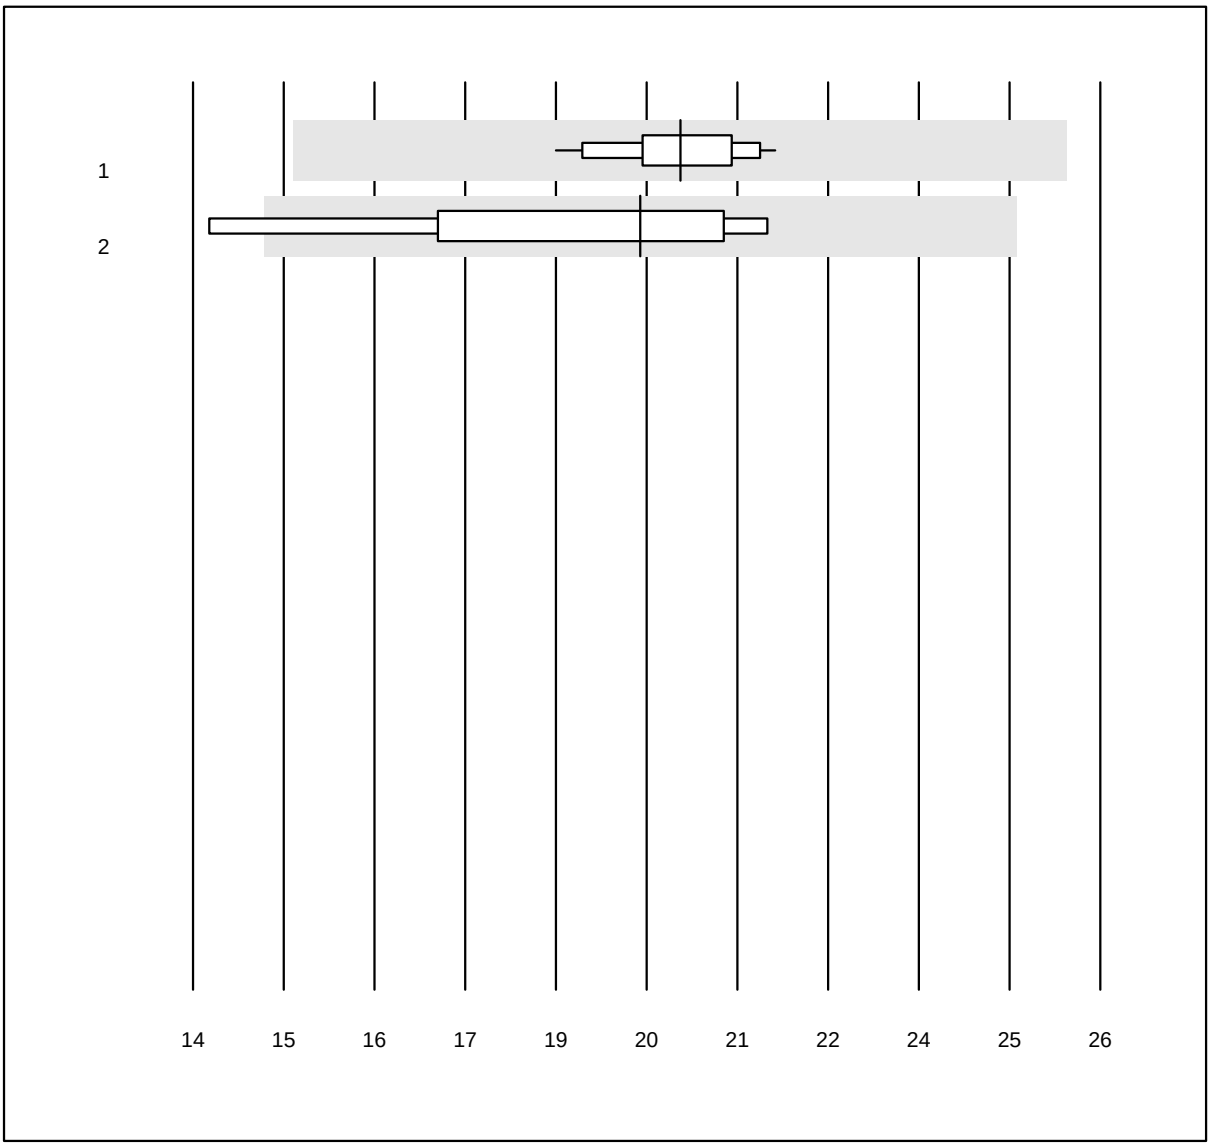


MQ Toleranz: 25%

AMH (pmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	14	100.0	0.0	0.0	20.4	3.9	e
2	VIDAS	5	100.0	0.0	0.0	19.9	11.7	a*

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Inhibin B

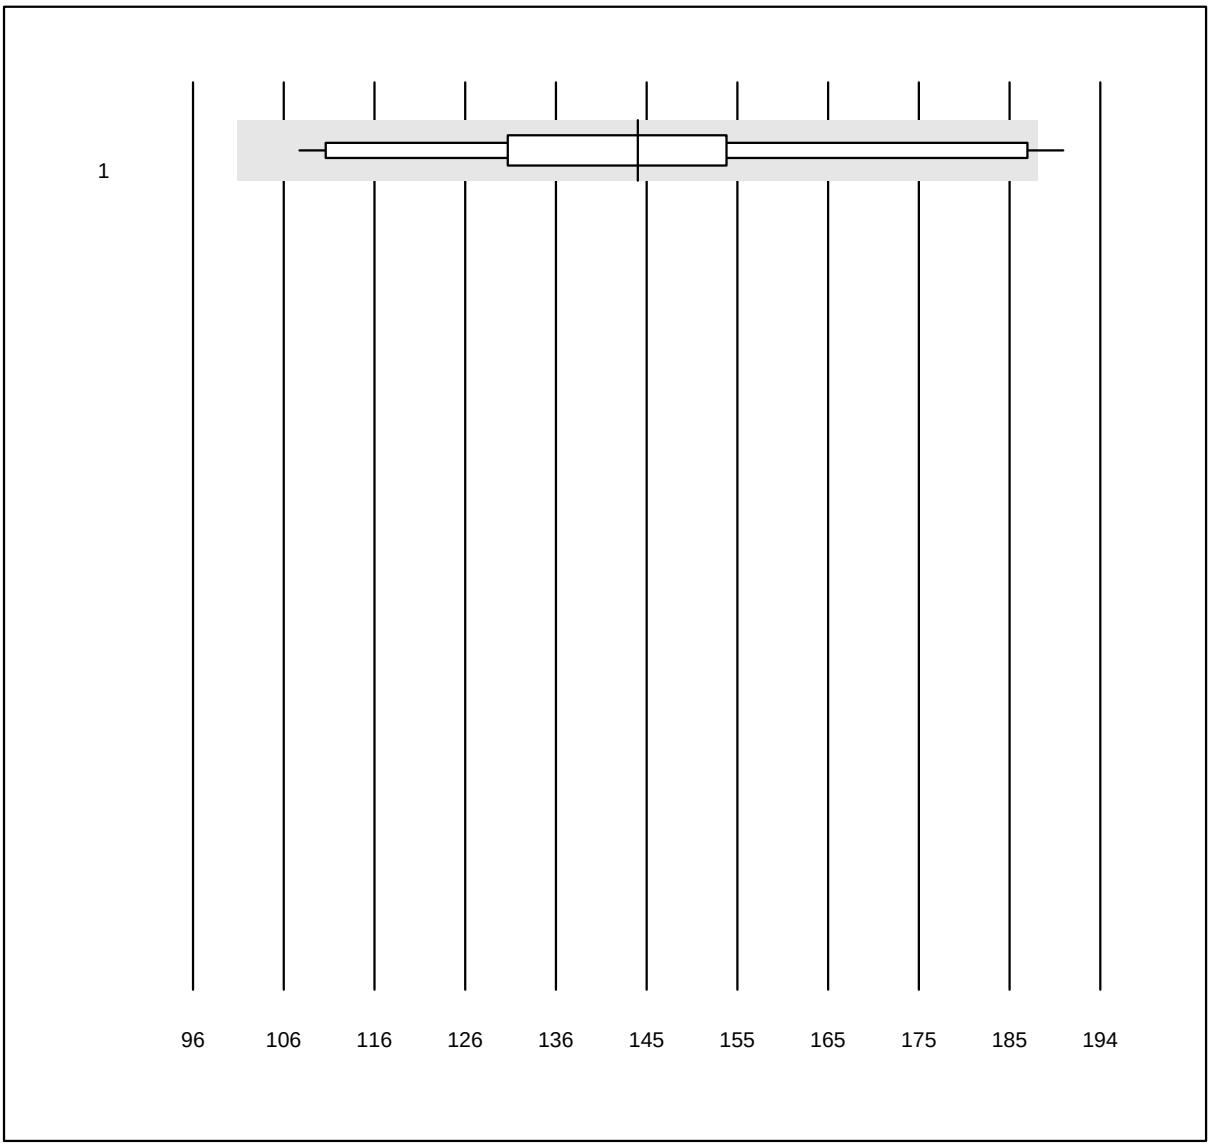


MQ Toleranz: 30%

Inhibin B (ng/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	toutes les méthodes	11	90.9	9.1	0.0	144.0	15.8	e*

Calcitonin

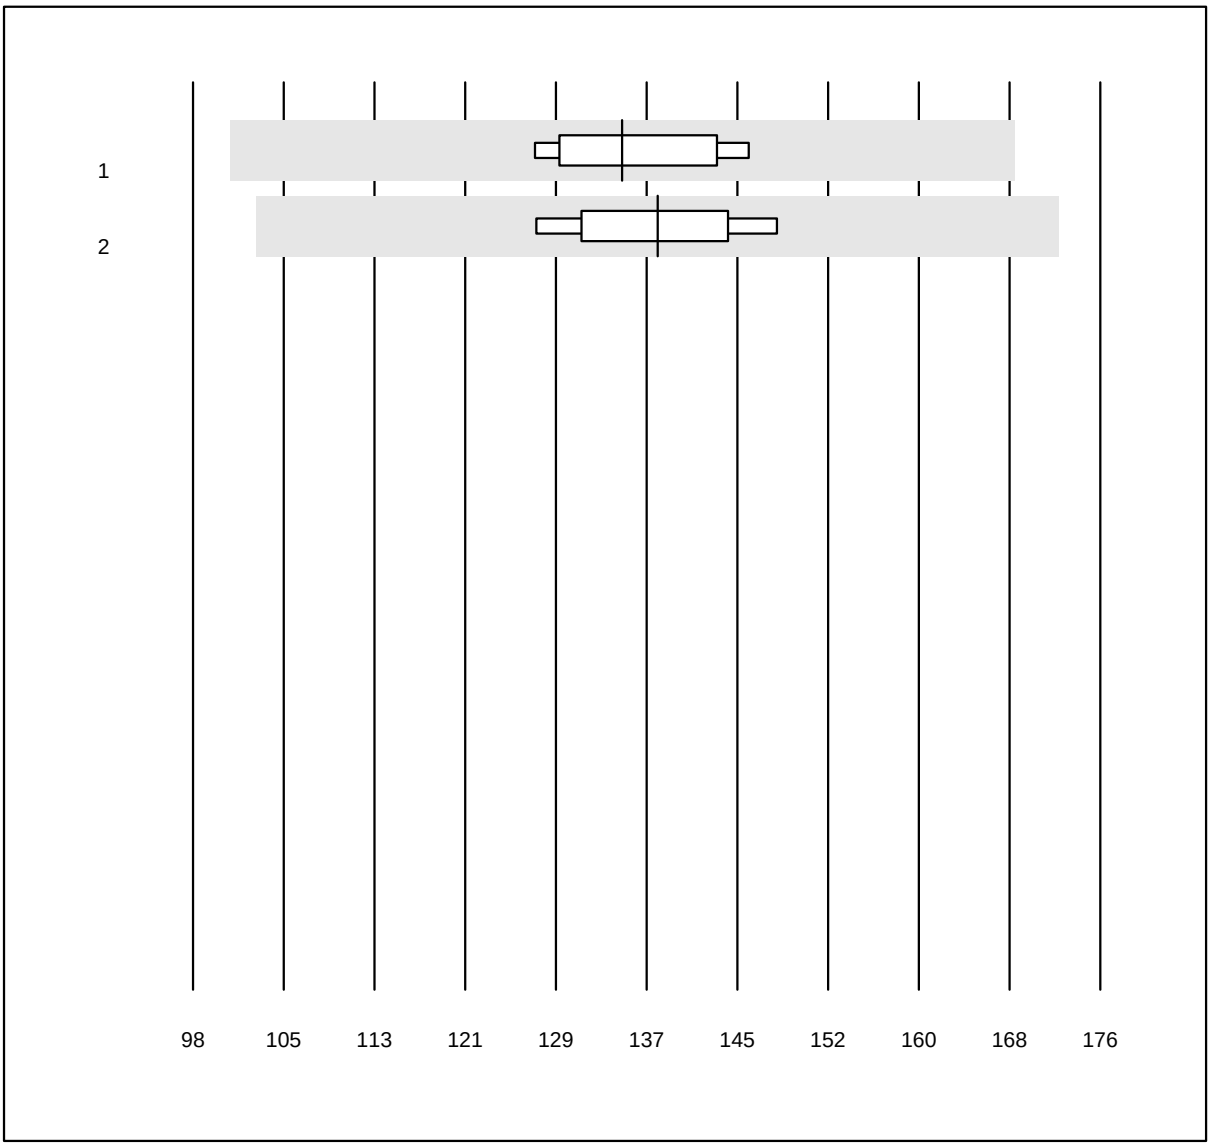


MQ Toleranz: 25%

Calcitonin (pmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Liaison	6	100.0	0.0	0.0	134.9	5.3	e
2	Autres méthodes	6	100.0	0.0	0.0	137.9	4.9	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Aldosteron

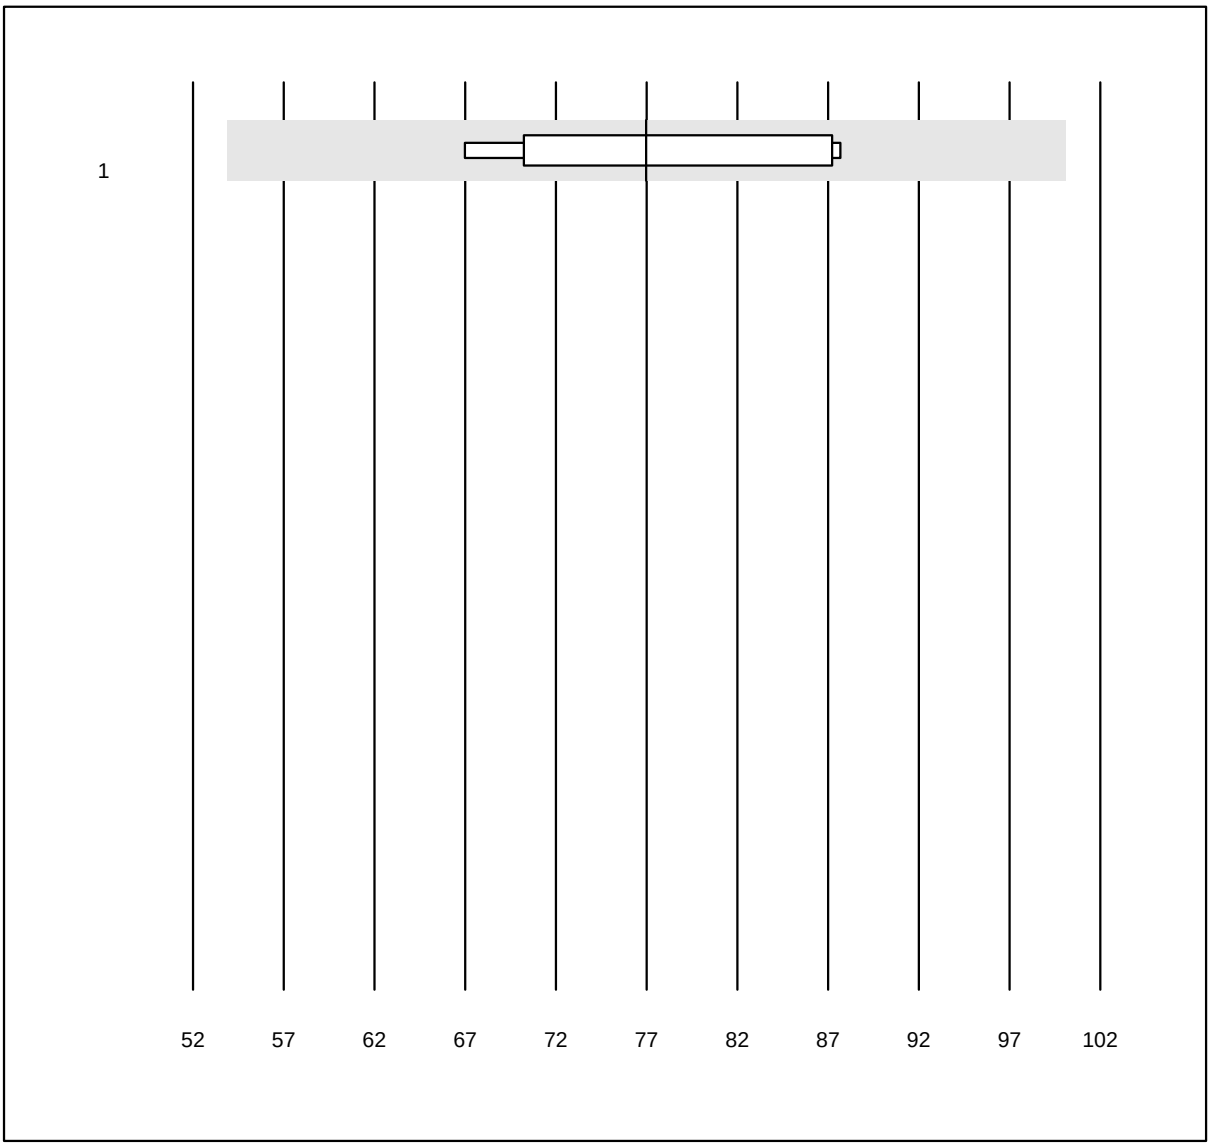


MQ Toleranz: 30%

Aldosteron (ng/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Liaison	7	100.0	0.0	0.0	77.0	9.8	e*

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

IGF-BP3

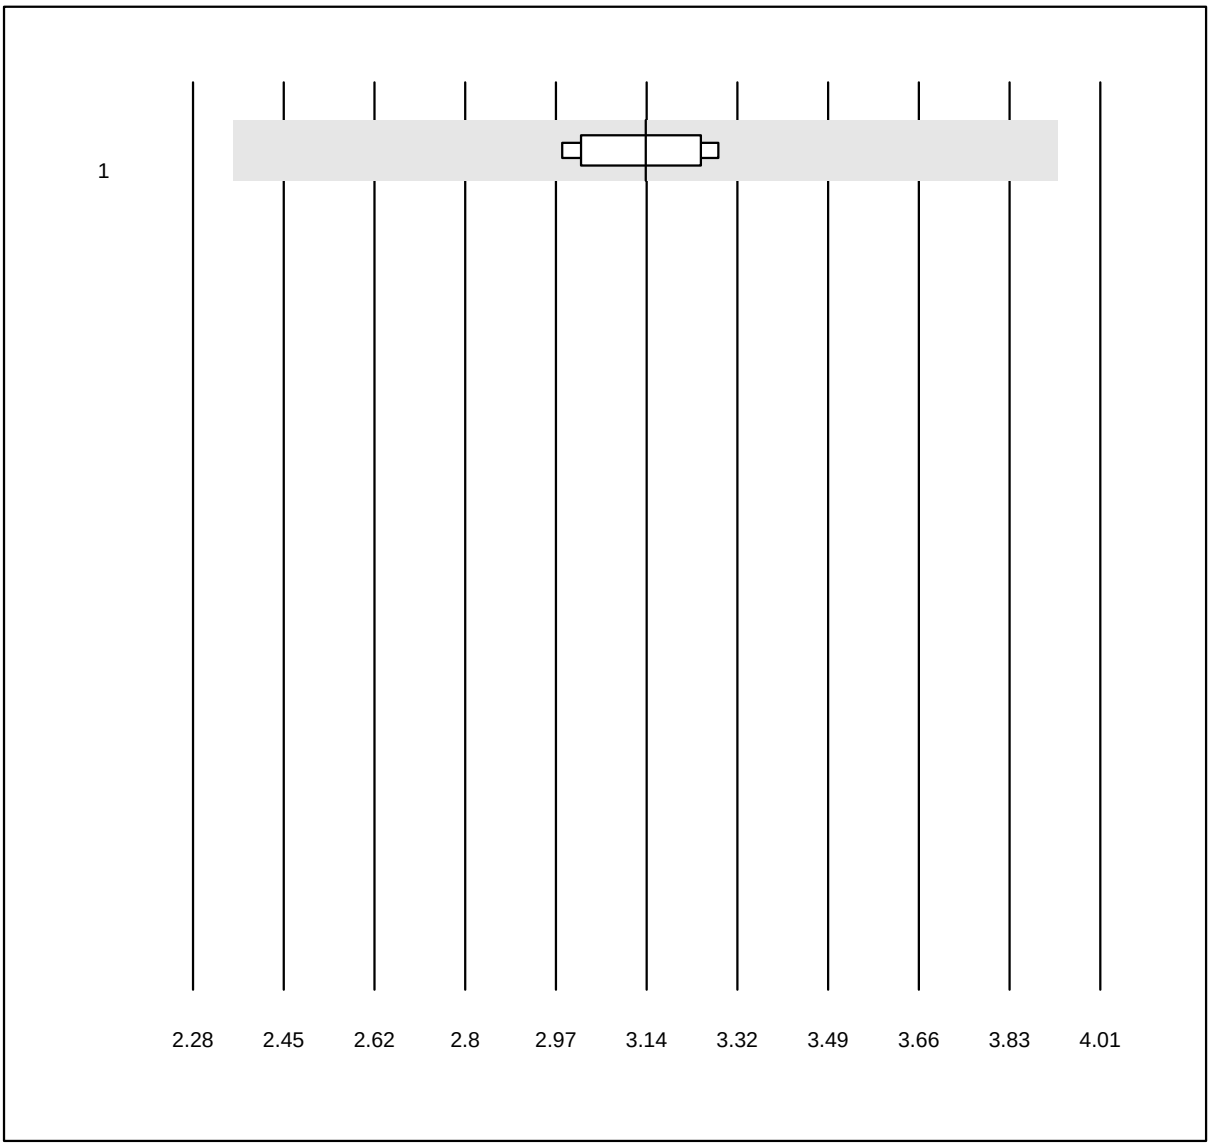


MQ Toleranz: 25%

IGF-BP3 (mg/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Cobas	5	100.0	0.0	0.0	3.14	3.7	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Rénine

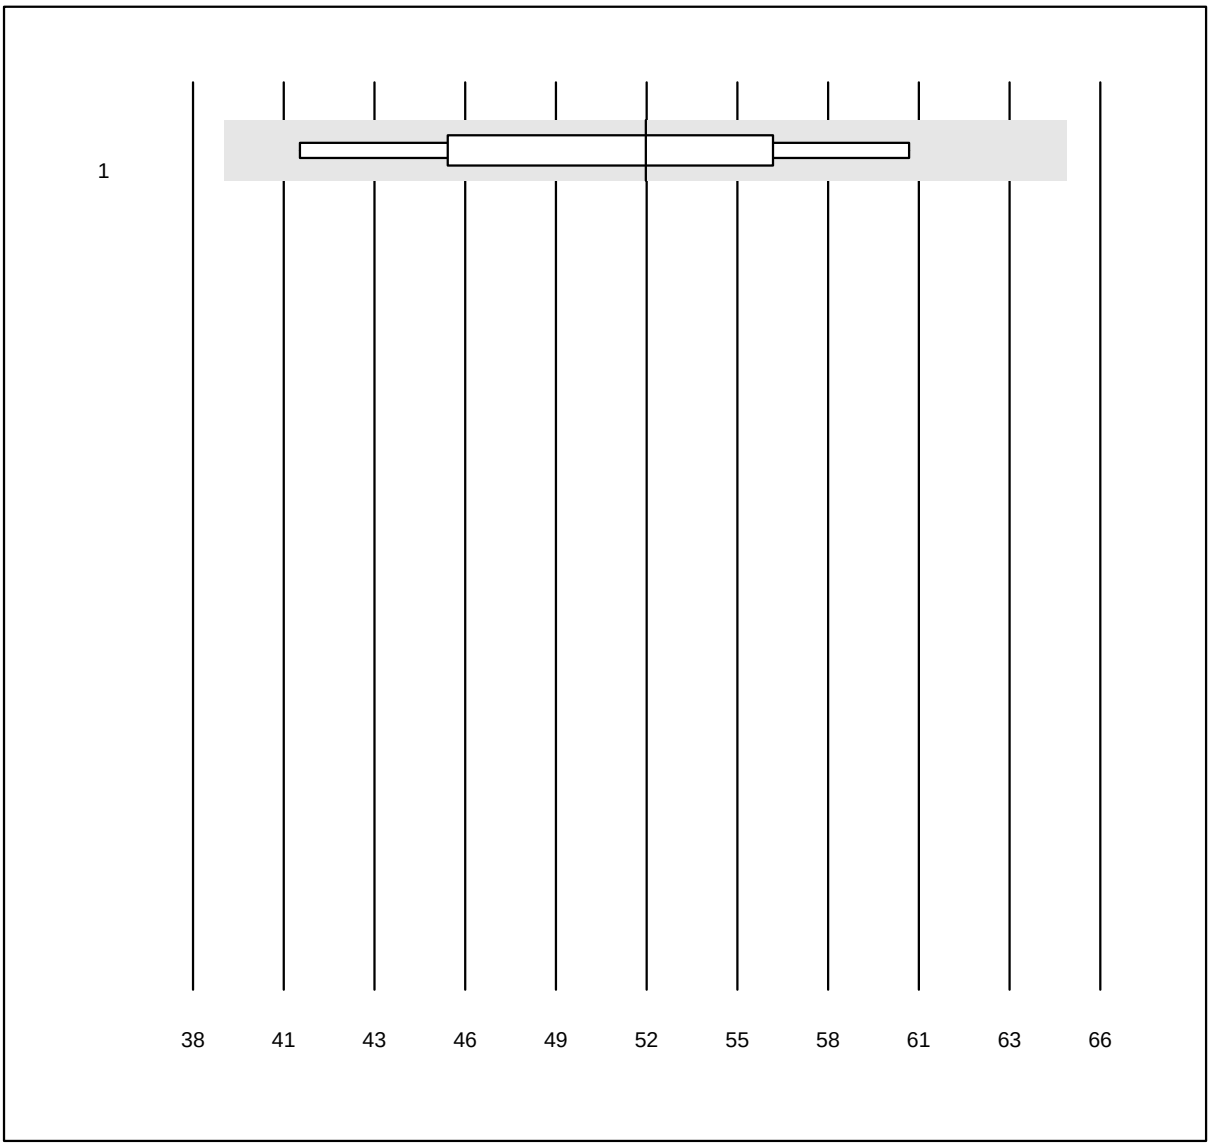


MQ Toleranz: 25%

Rénine (mU/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Liaison	9	100.0	0.0	0.0	52.0	11.6	e*

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Anti-thyréoglobuline

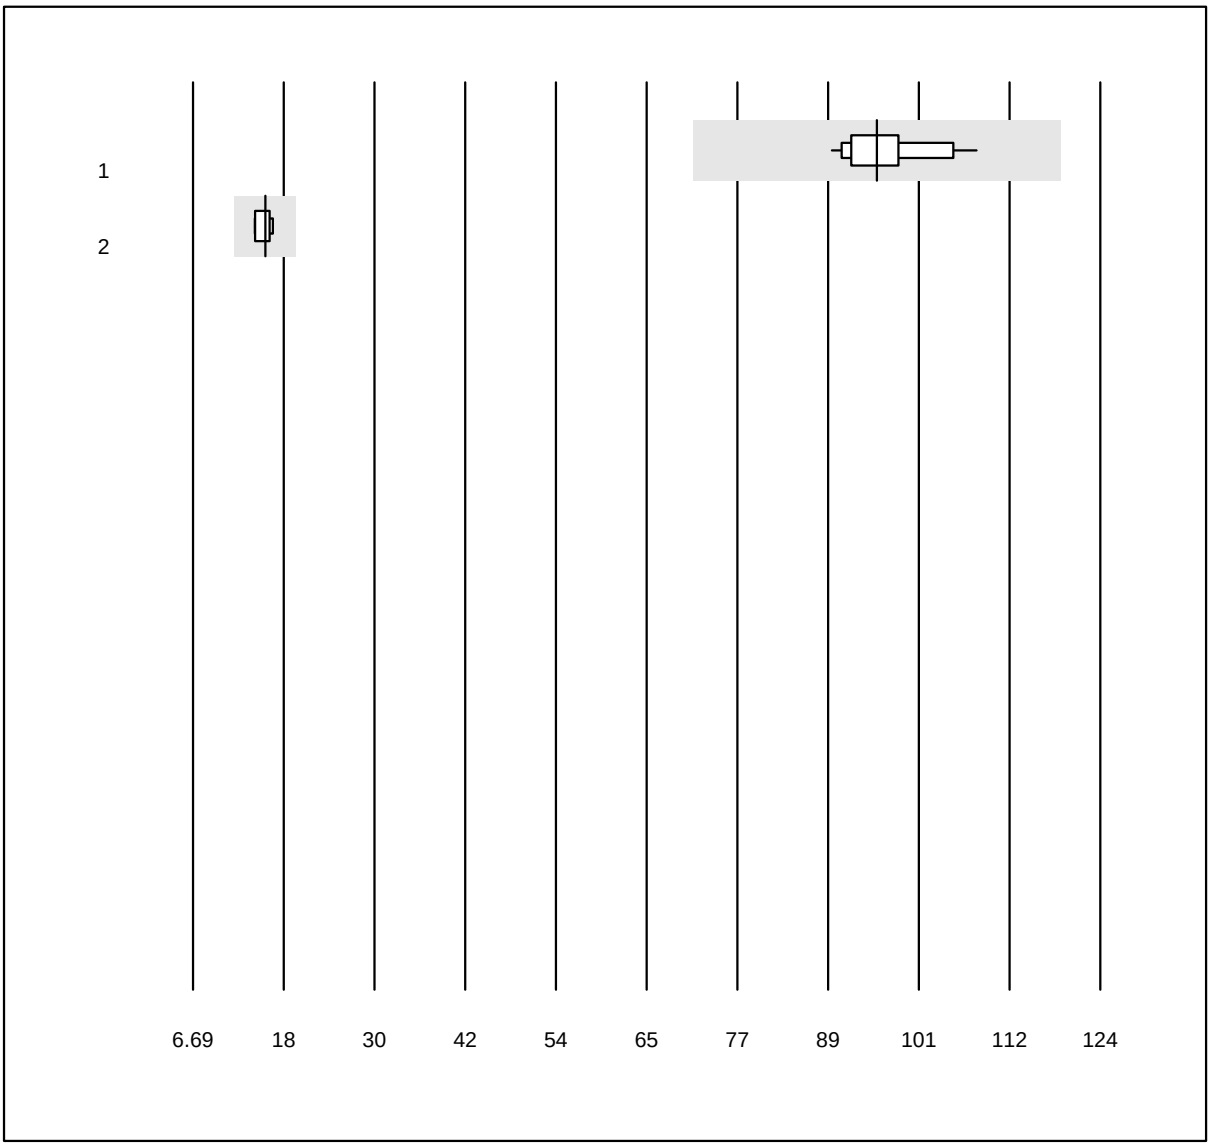


MQ Toleranz: 25%

Anti-thyréoglobuline (IU/ml)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	15	100.0	0.0	0.0	95.1	5.2	e
2	Alinity	6	100.0	0.0	0.0	16.1	5.8	e

5 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Anti TPO

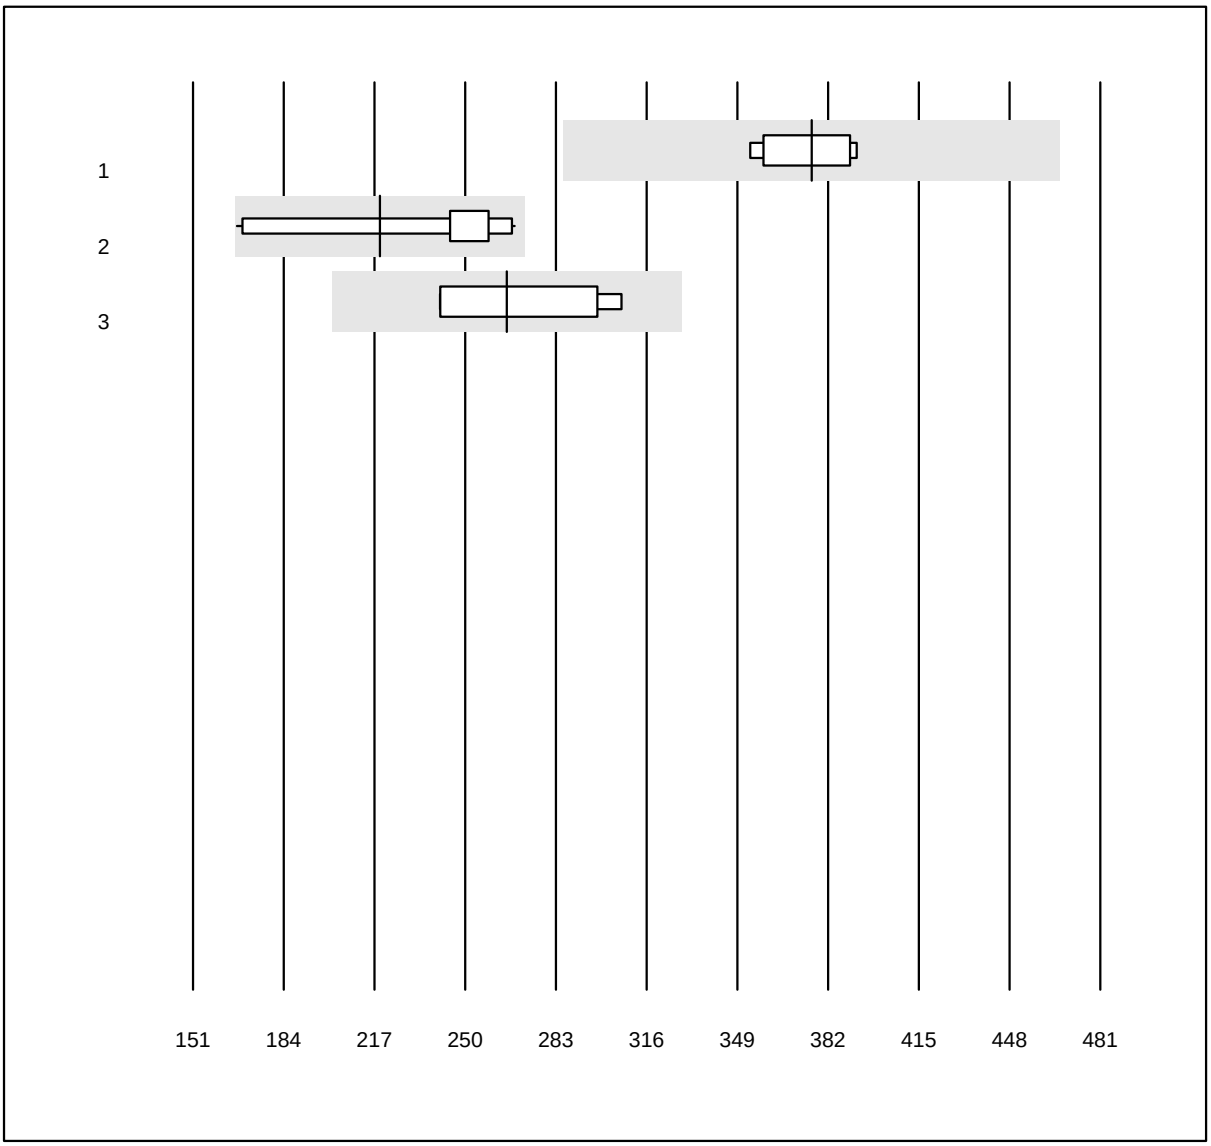


QUALAB Toleranz: 24%

Anti TPO (IU/ml)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	7	100.0	0.0	0.0	376.0	4.4	e
2	Roche	14	100.0	0.0	0.0	219.0	13.2	a*
3	Phadia	4	100.0	0.0	0.0	265.1	11.8	e*

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

TRAK

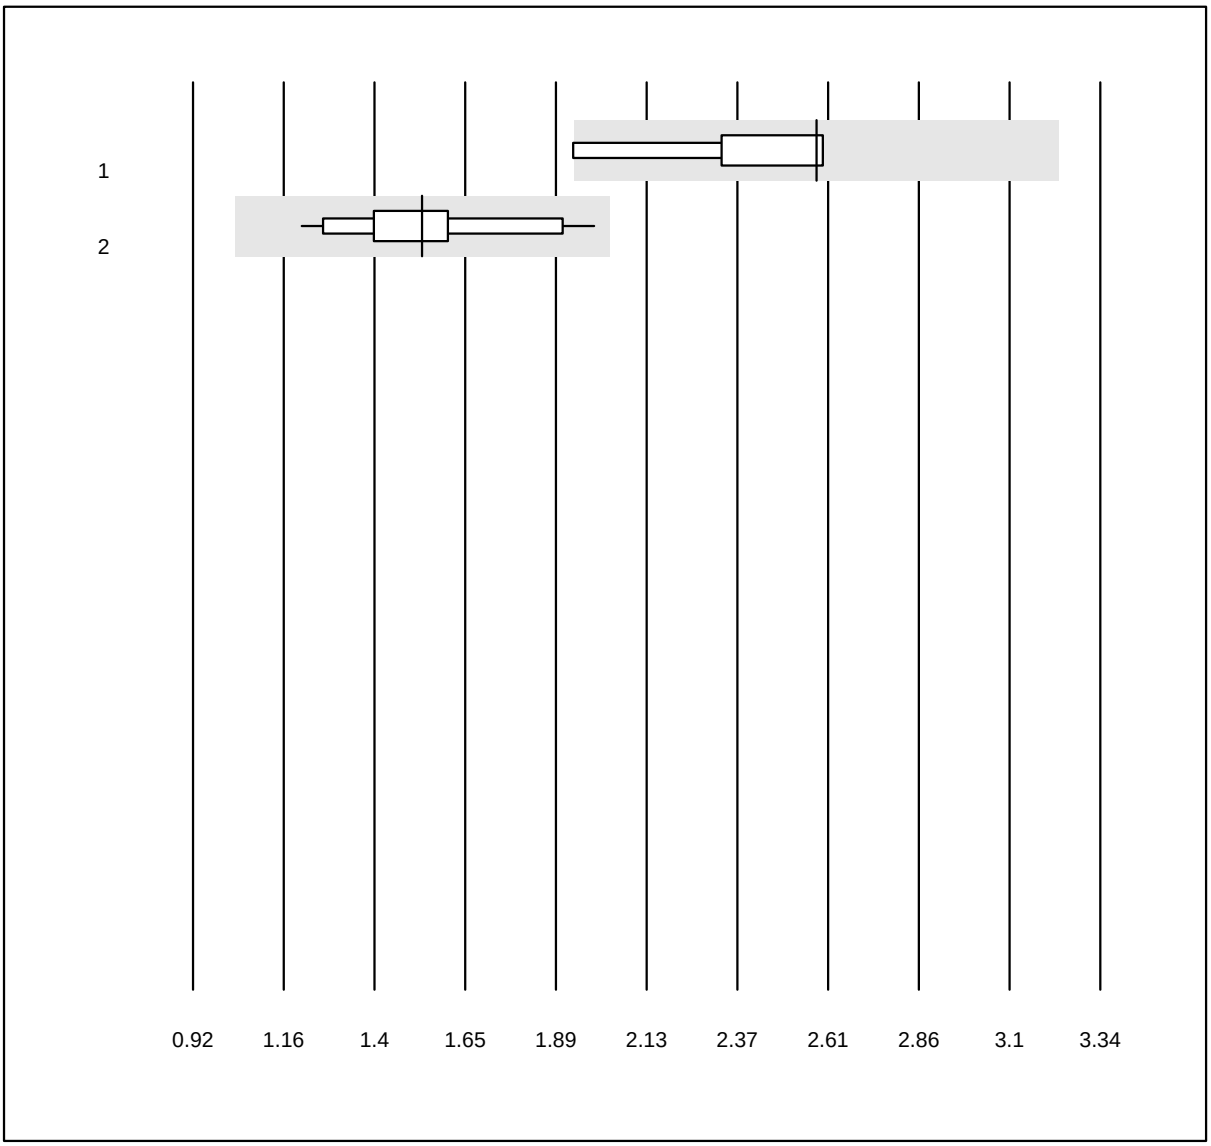


MQ Toleranz: 25%

TRAK (IU/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	5	100.0	0.0	0.0	2.58	8.6	e*
2	Roche	12	100.0	0.0	0.0	1.53	12.6	e

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Créatinine WB

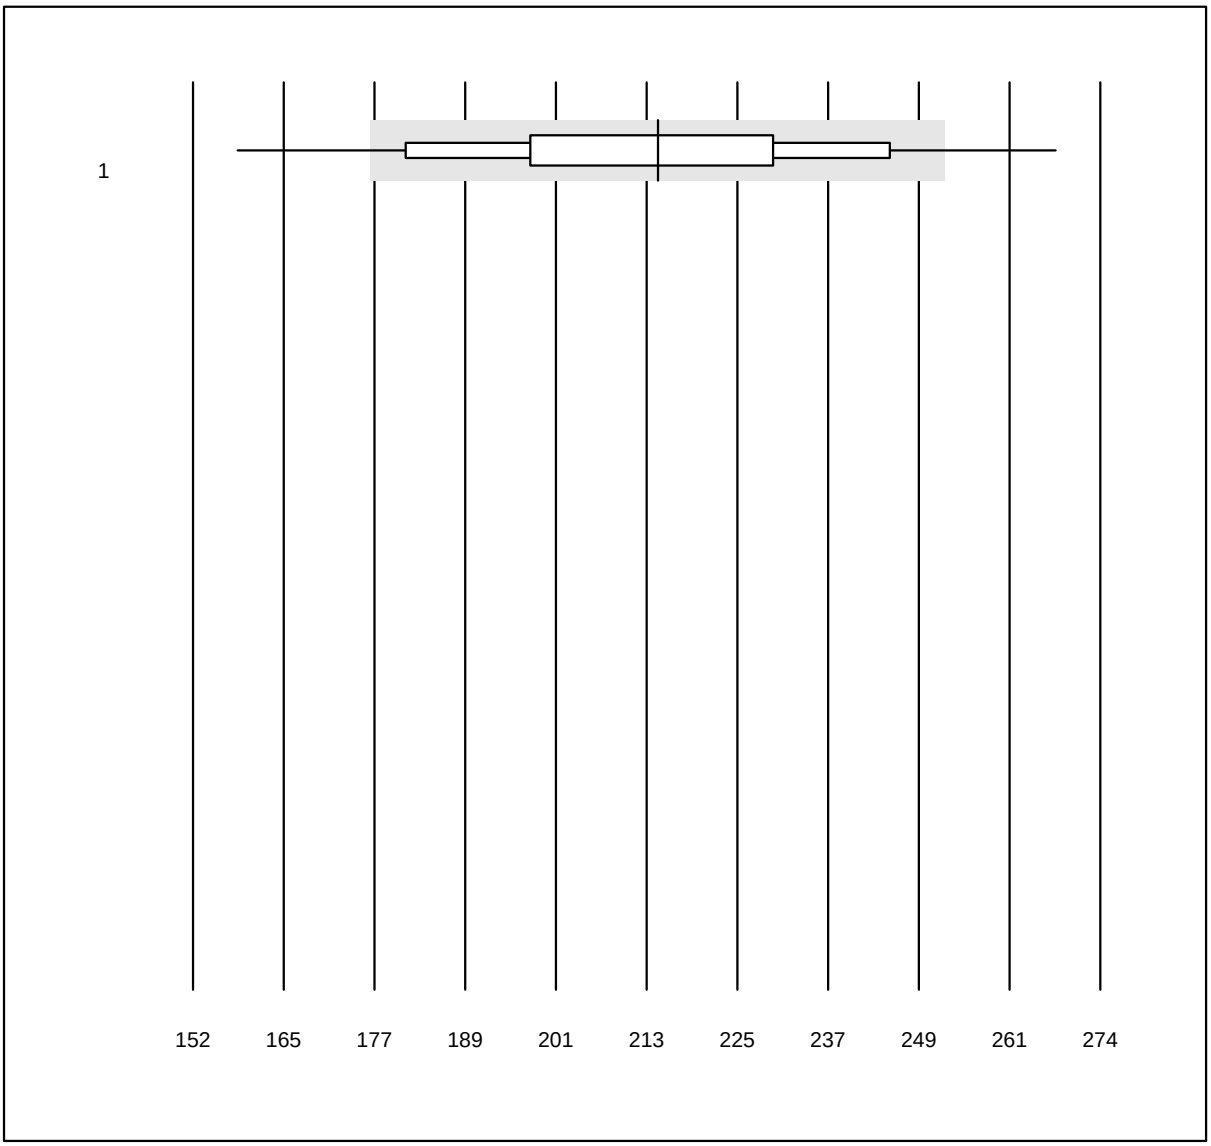


QUALAB Toleranz: 18%

Créatinine WB (µmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Statsensor i / Nova	94	89.4	8.5	2.1	215	10.8	e

eGFR CDK-EPI WB

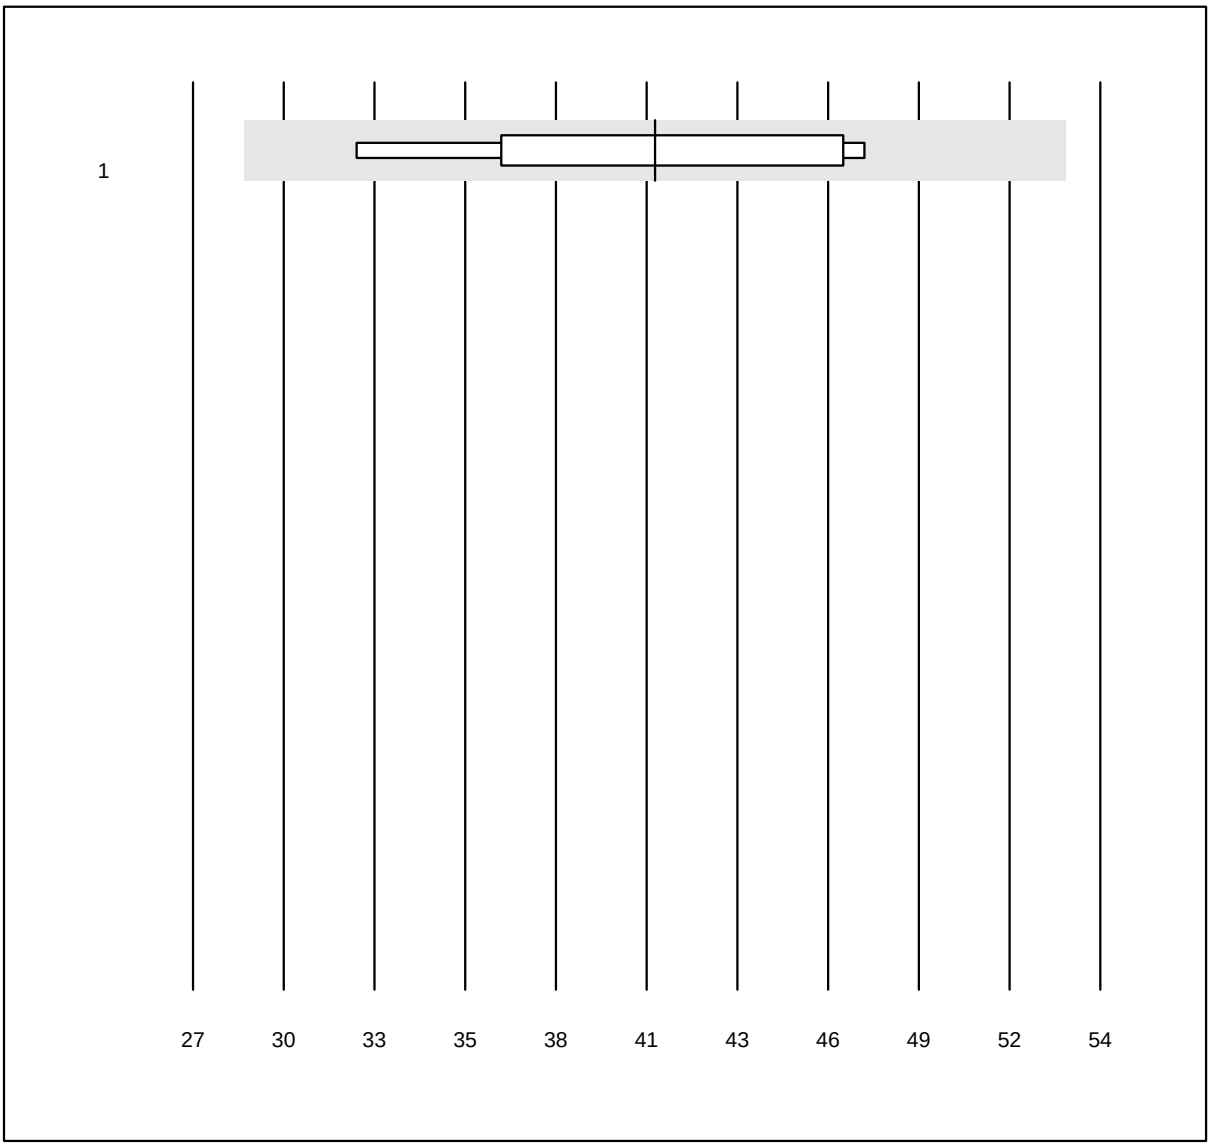


MQ Toleranz: 30%

eGFR CDK-EPI WB ()

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Statsensor i / Nova	6	100.0	0.0	0.0	41	13.7	e*

Keton WB

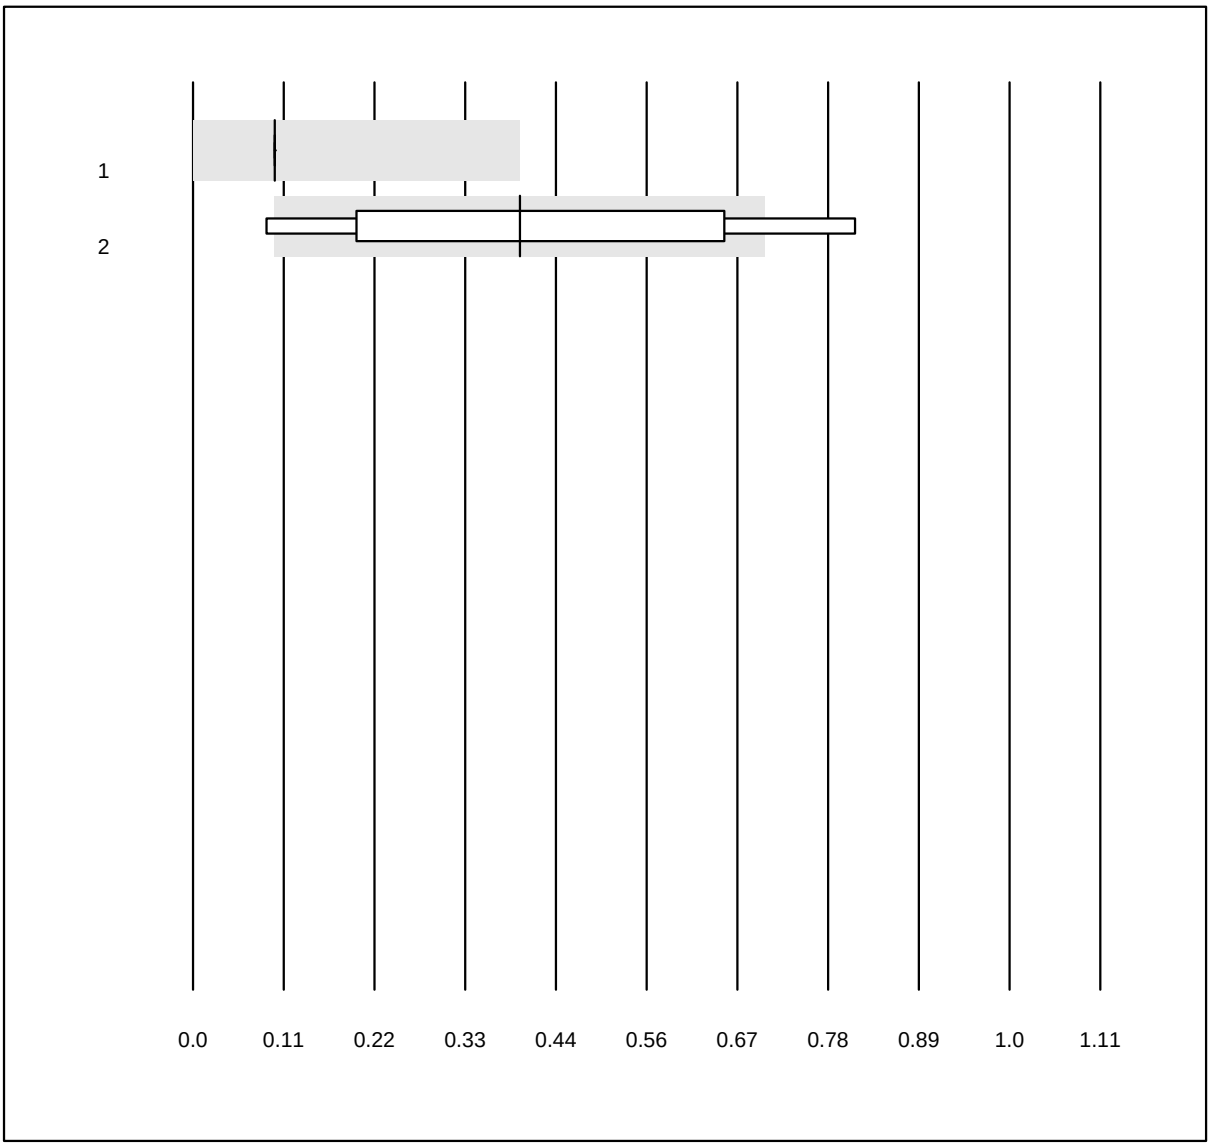


MQ Toleranz: 40%
(< 1.0: +/- 0.3 mmol/l)

Keton WB (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Autres méthodes	9	100.0	0.0	0.0	0.100	0.0	a
2	Ketosure APEXBIO	8	75.0	25.0	0.0	0.400	62.7	a*

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

IL6

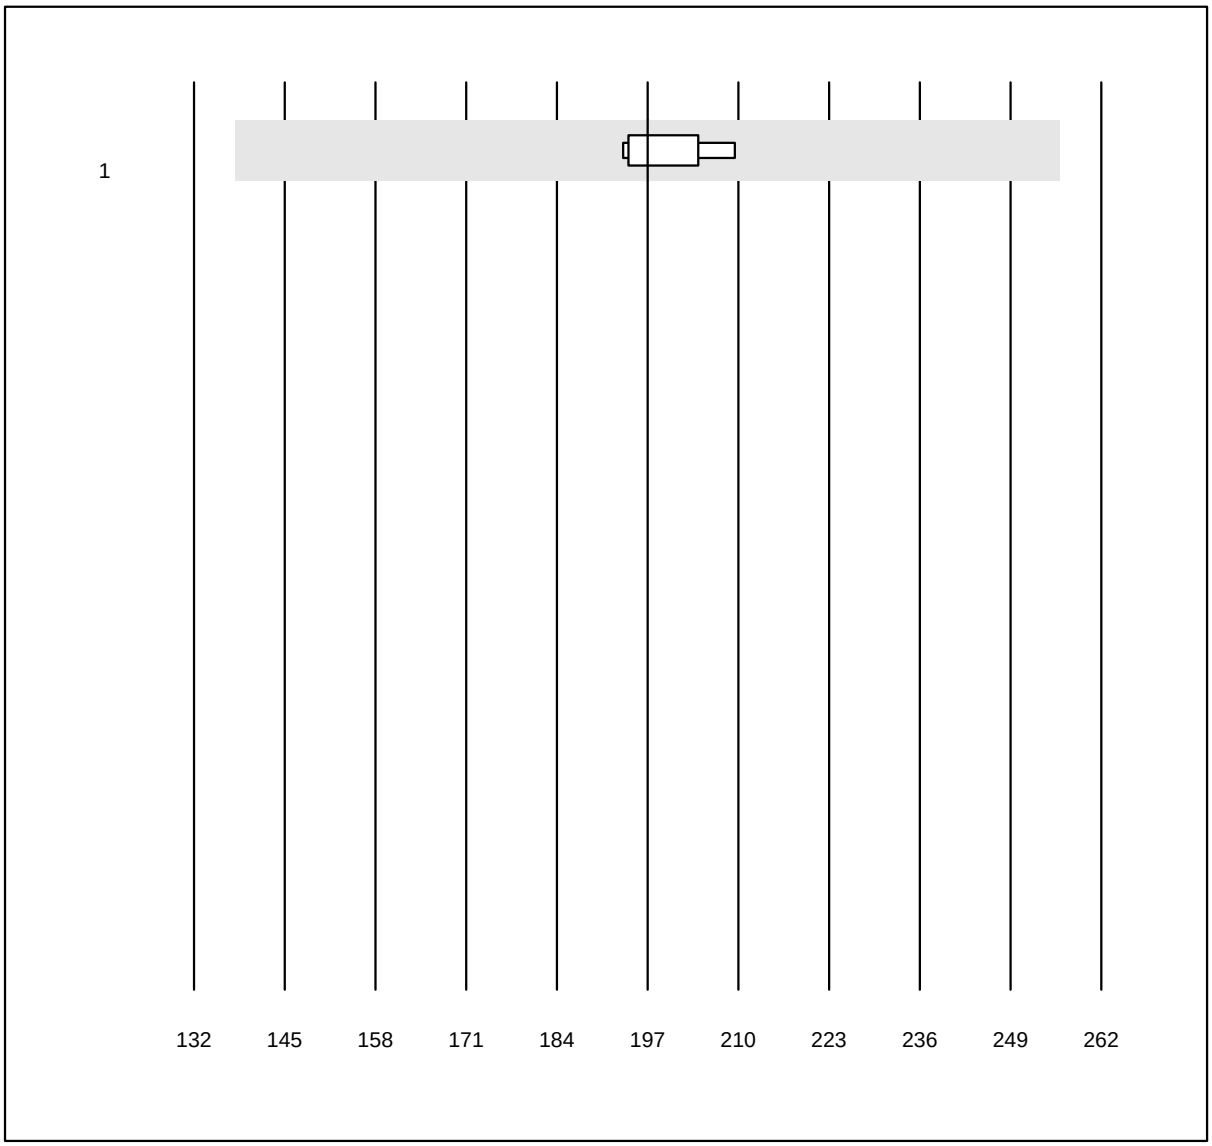


MQ Toleranz: 30%

IL6 (ng/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	4	100.0	0.0	0.0	197.0	2.7	e

Pankreas Elastase

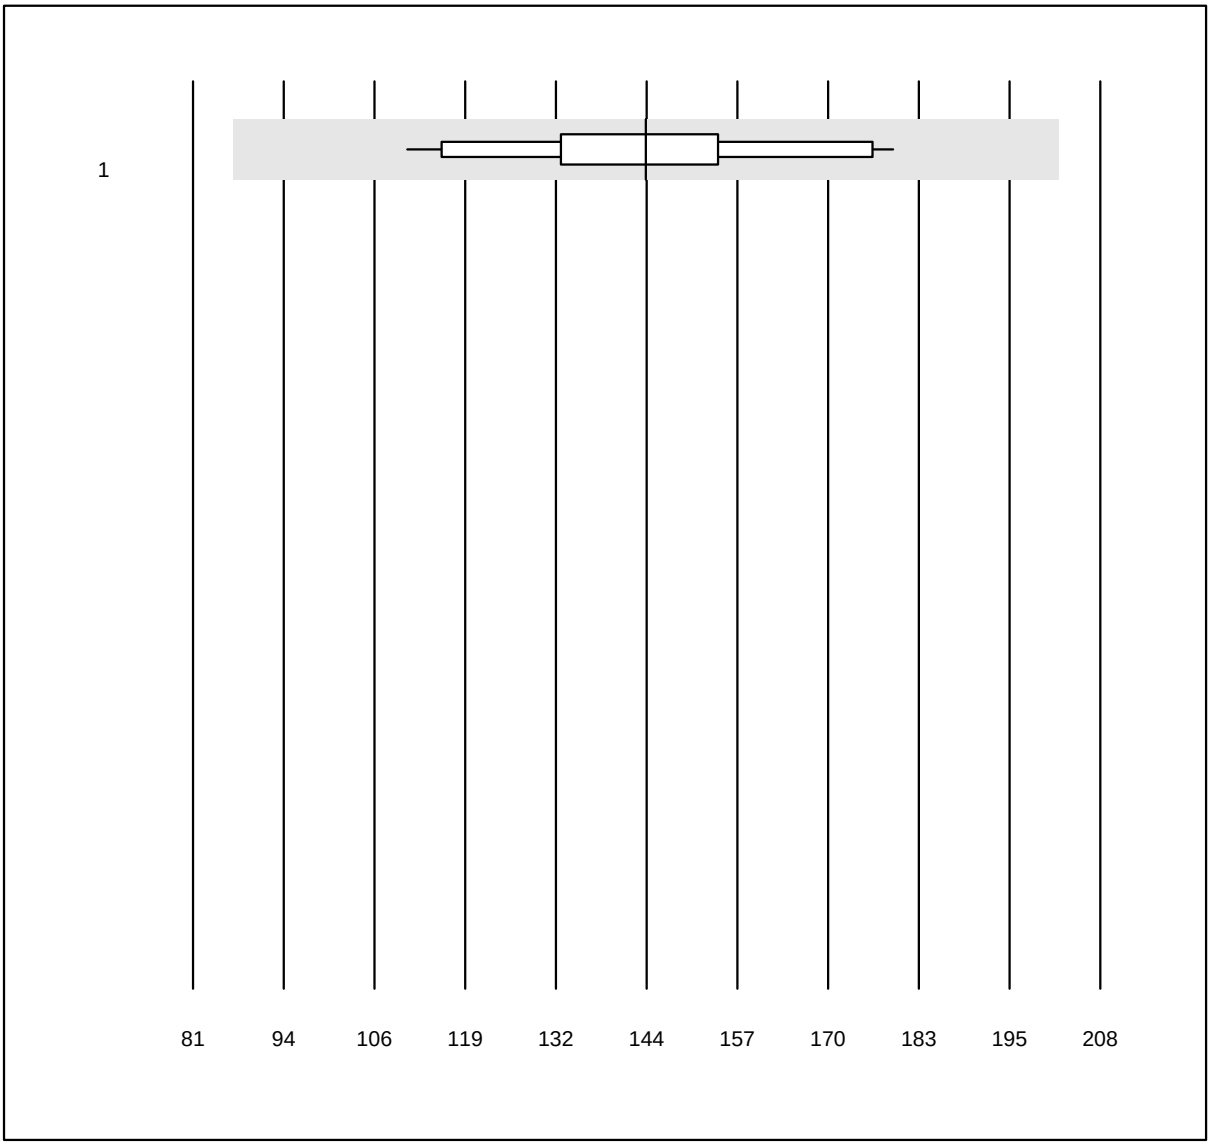


MQ Toleranz: 40%

Pankreas Elastase (µg/g)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Autres méthodes	18	94.4	0.0	5.6	144	13.0	e

Copeptin

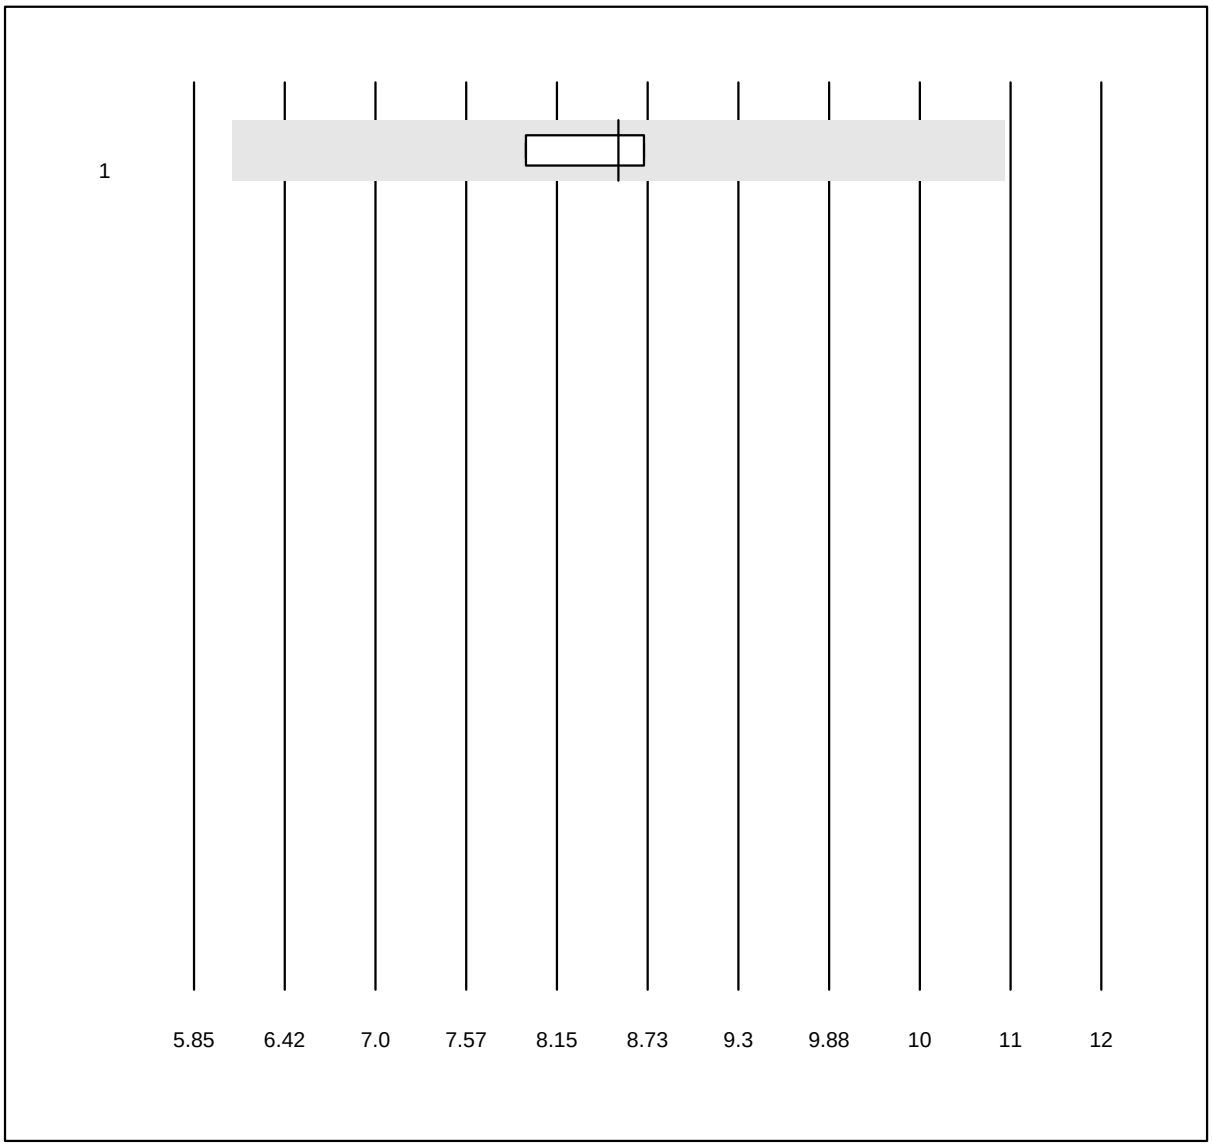


MQ Toleranz: 30%

Copeptin (pmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Kryptor	7	100.0	0.0	0.0	8.7	4.1	e

PlGF

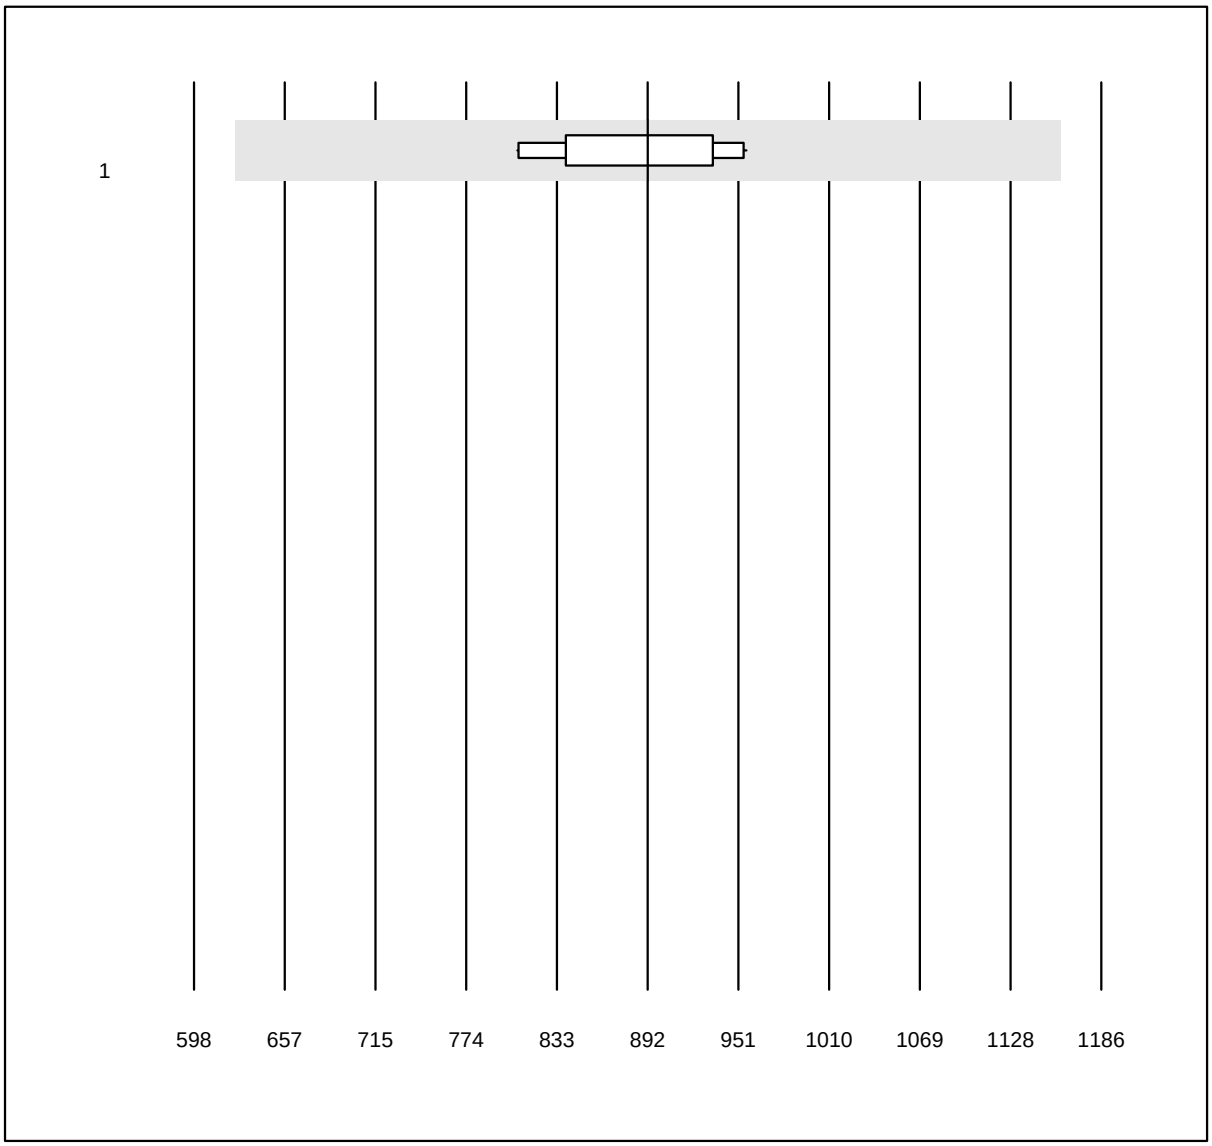


MQ Toleranz: 30%

PlGF (pg/ml)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	10	100.0	0.0	0.0	892.1	6.1	e

SFIT1

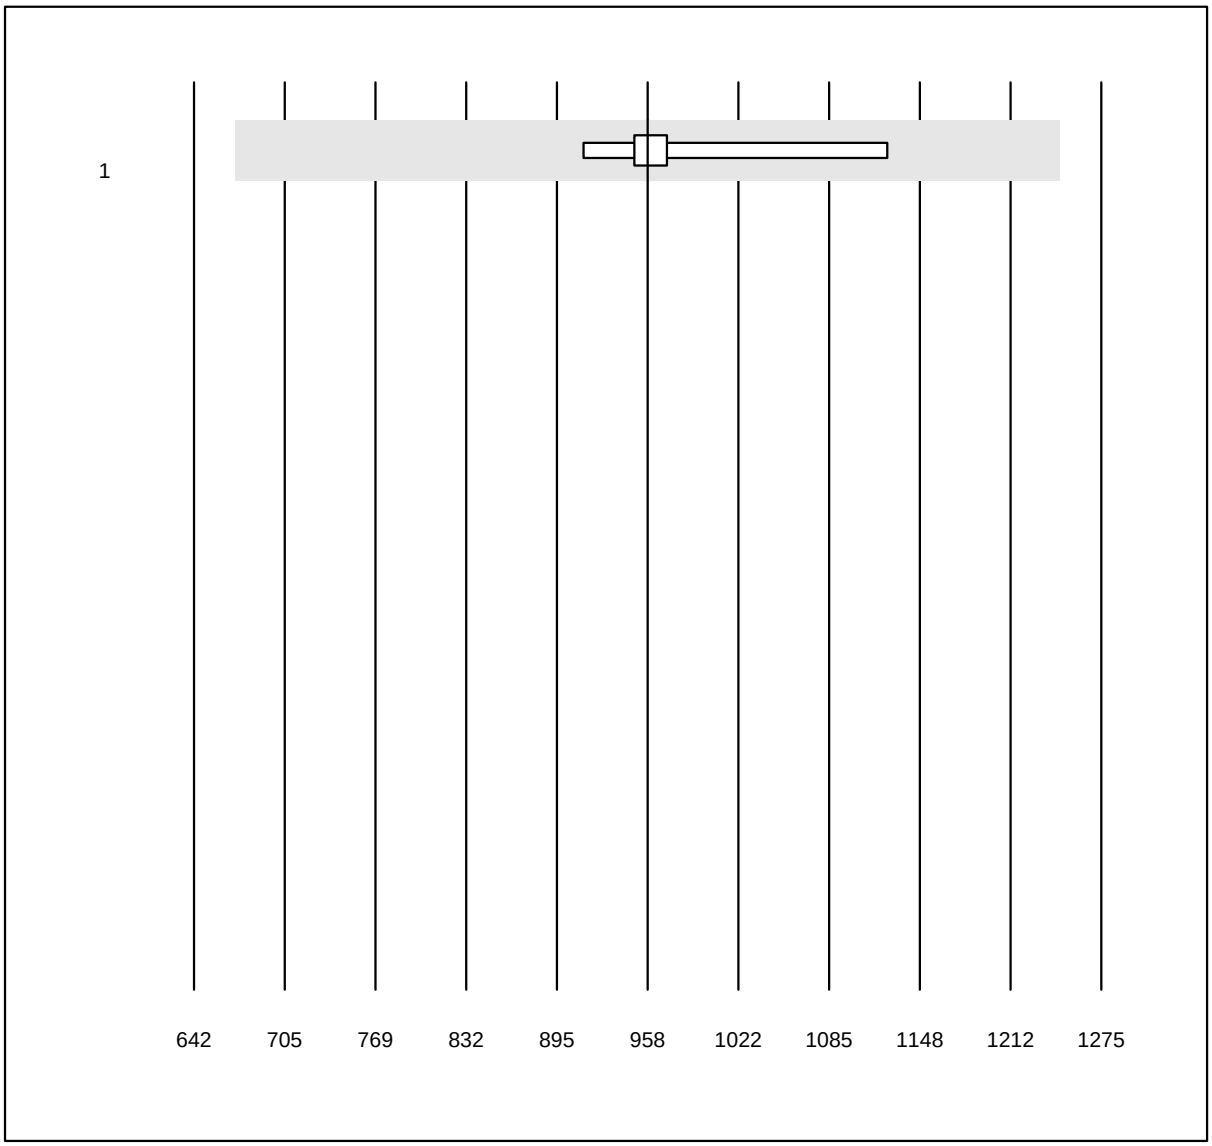


MQ Toleranz: 30%

SFIT1 (pg/ml)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	8	100.0	0.0	0.0	958.5	6.0	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)


tHb

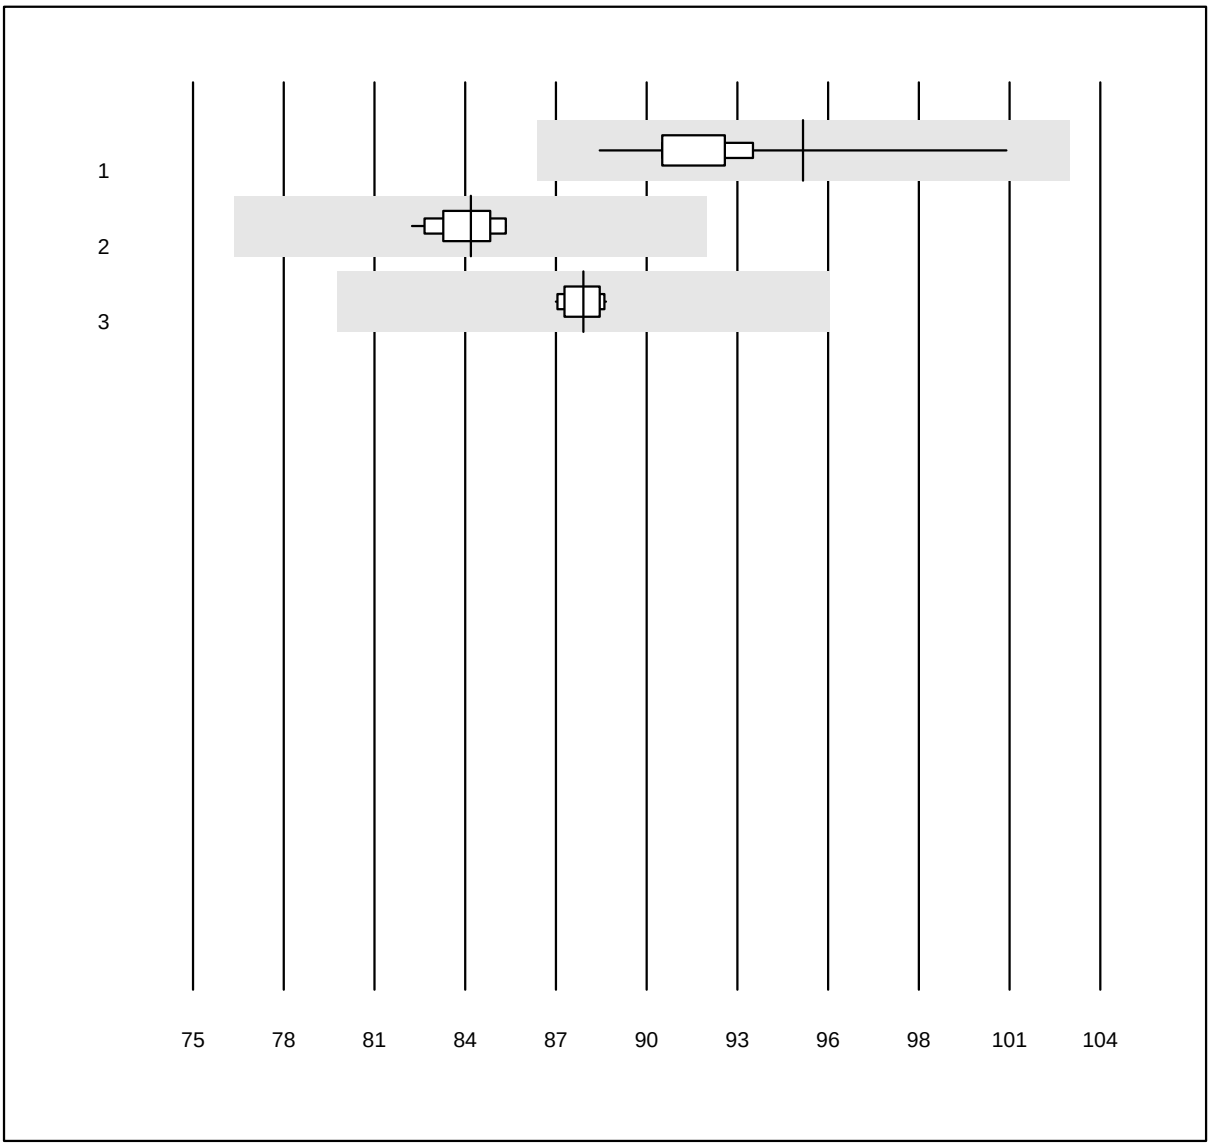

MQ Toleranz: 9% tHb (g/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	RAPIDPoint 500	30	100.0	0.0	0.0	94.5	2.9	a
2	GEM	13	100.0	0.0	0.0	83.9	1.1	e
3	Cobas b 123	14	100.0	0.0	0.0	87.5	0.7	e

O2Hb

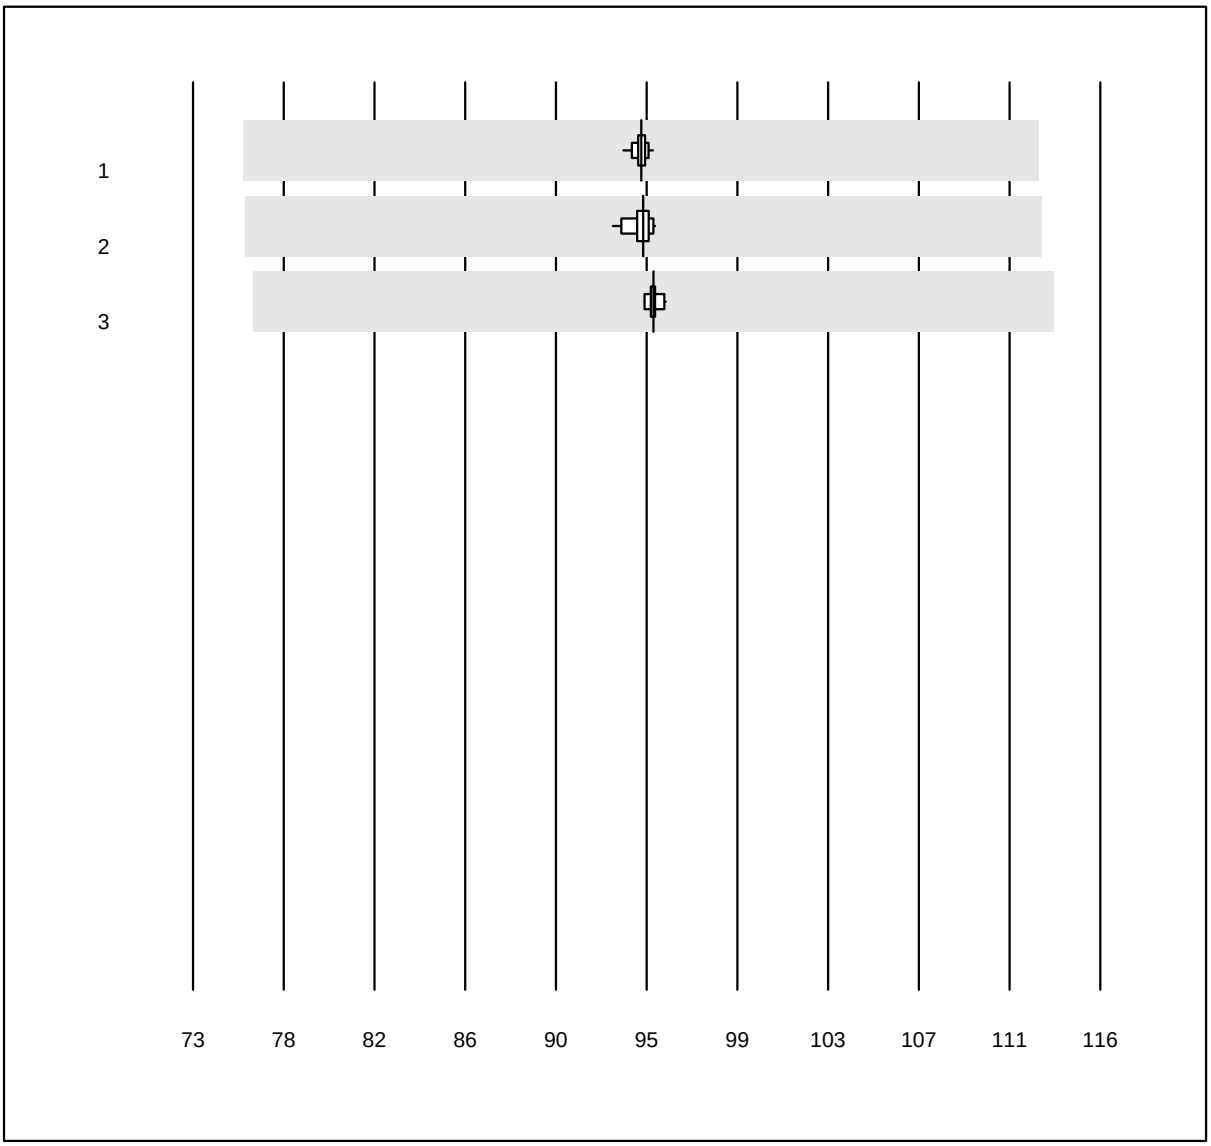


MQ Toleranz: 20%

O2Hb (%)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	RAPIDPoint 500	30	100.0	0.0	0.0	94.2	0.3	e
2	GEM	13	100.0	0.0	0.0	94.3	0.5	e
3	Cobas b 123	11	100.0	0.0	0.0	94.8	0.3	e

COHb

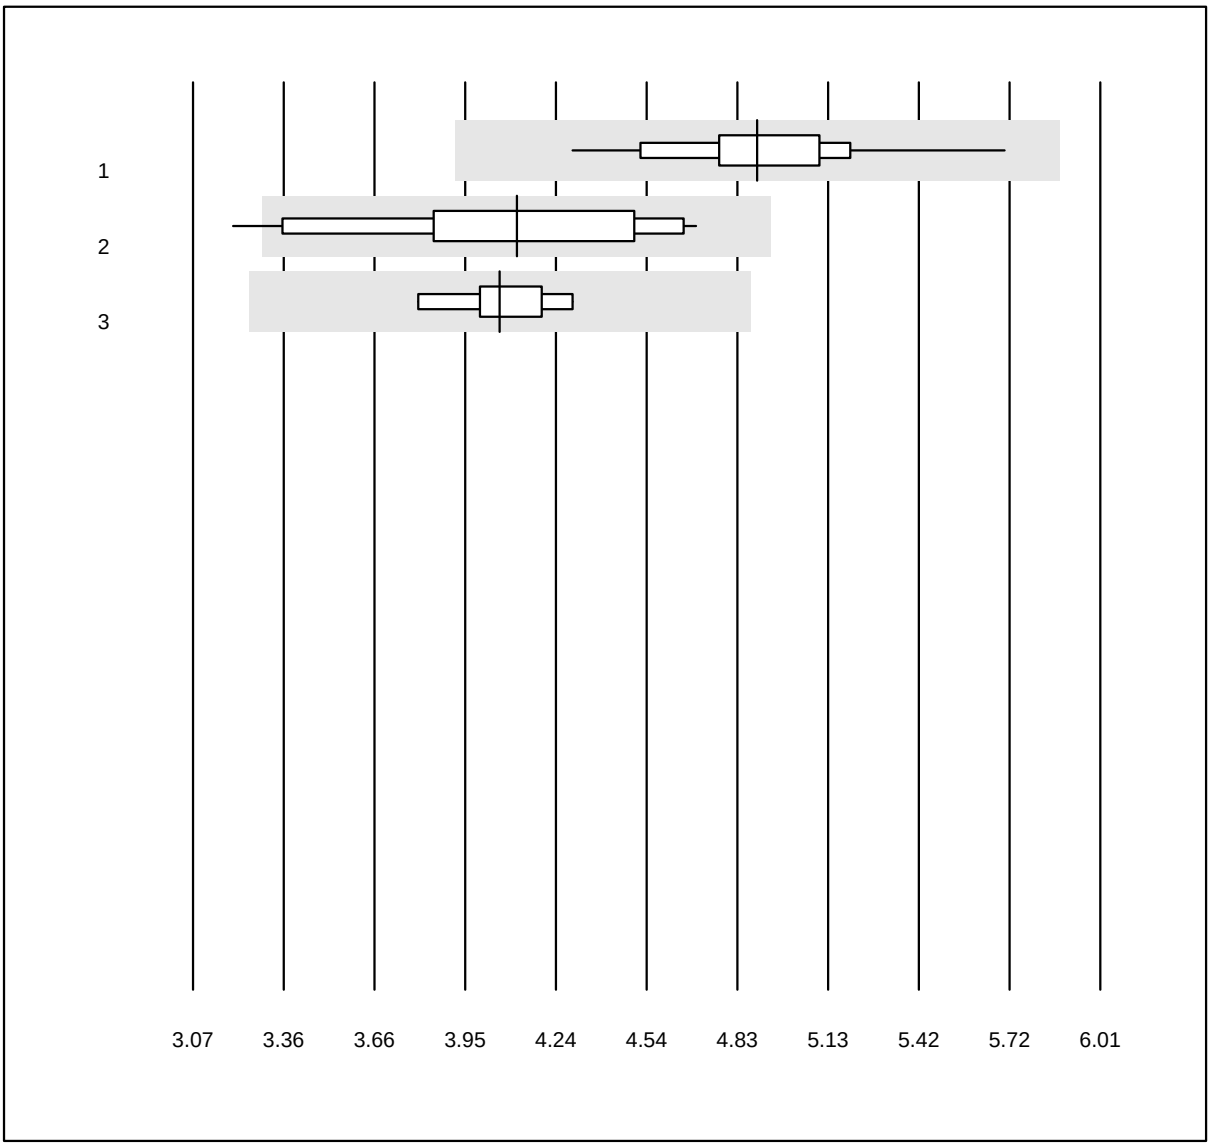


MQ Toleranz: 20%

COHb (%)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	RAPIDPoint 500	30	100.0	0.0	0.0	4.9	6.0	e
2	GEM	13	92.3	7.7	0.0	4.1	10.5	e*
3	Cobas b 123	11	100.0	0.0	0.0	4.1	4.3	e

MetHb

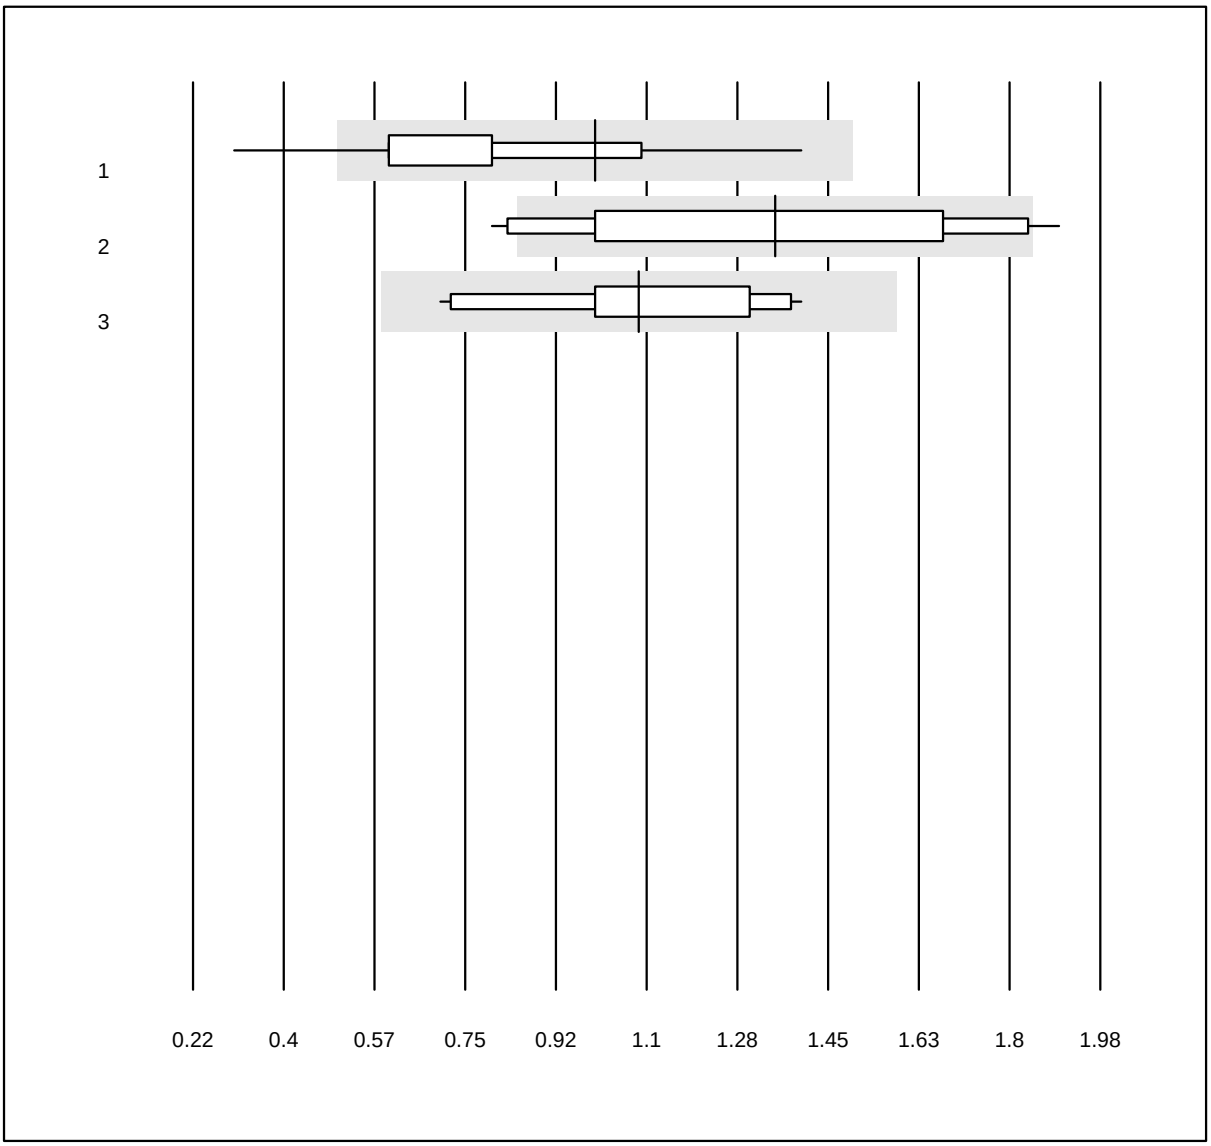


MQ Toleranz: 20%
(< 1.5: +/- 0.5 %)

MetHb (%)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	RAPIDPoint 500	30	96.7	3.3	0.0	1.0	28.6	a
2	GEM	13	76.9	15.4	7.7	1.3	28.3	e*
3	Cobas b 123	11	100.0	0.0	0.0	1.1	19.7	e*

sO2

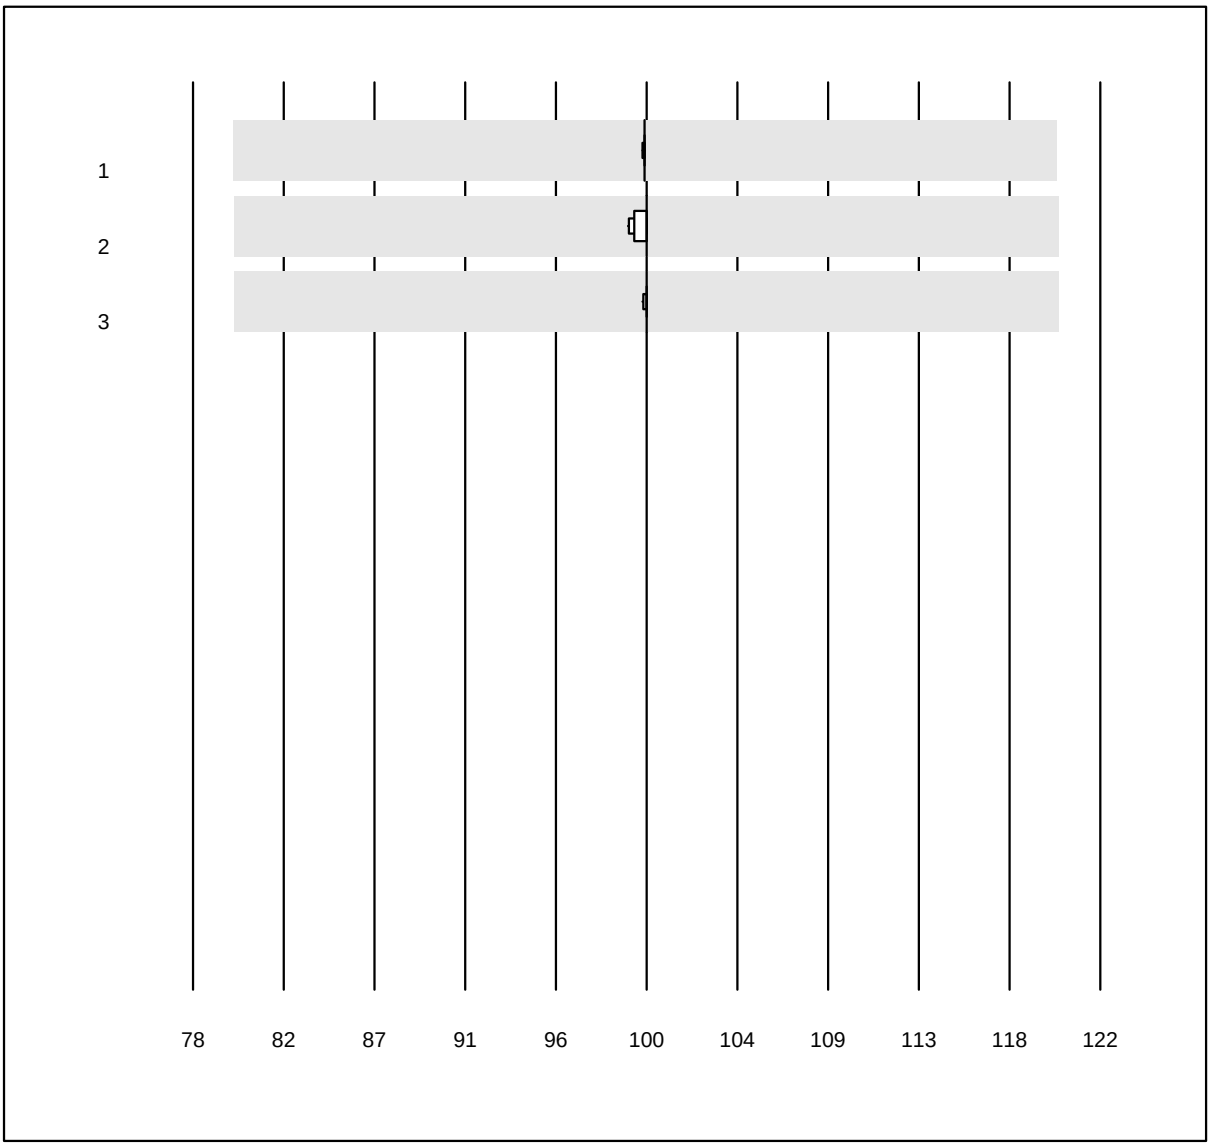


MQ Toleranz: 20%

sO2 (%)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	RAPIDPoint 500	28	100.0	0.0	0.0	99.9	0.0	e
2	GEM	13	100.0	0.0	0.0	100.0	0.4	e
3	Cobas b 123	11	100.0	0.0	0.0	100.0	0.1	e

CTx (CrossLaps)

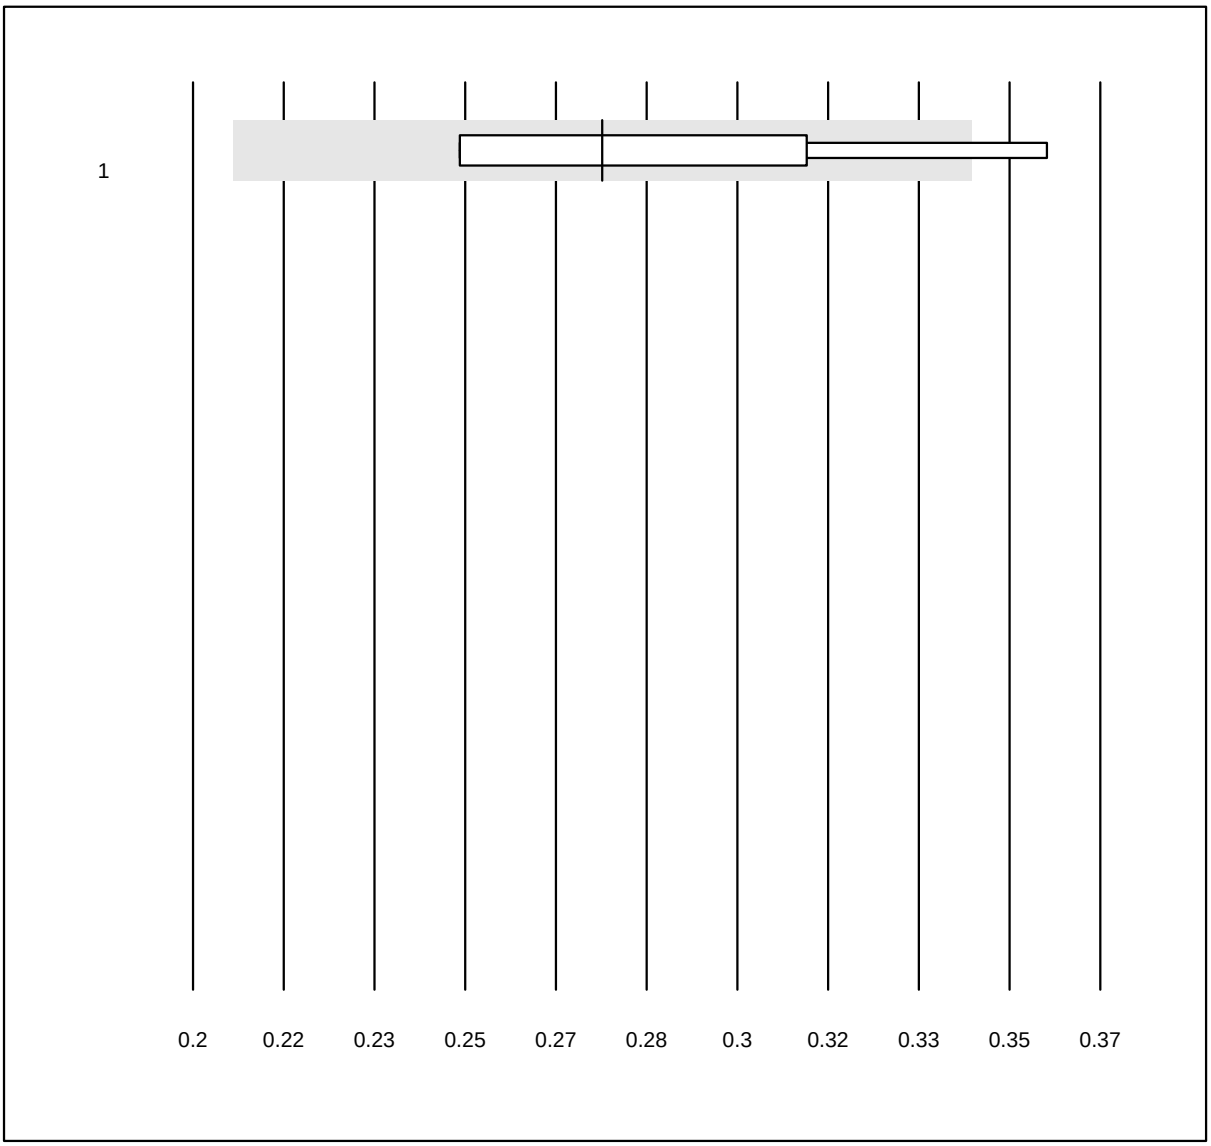


MQ Toleranz: 25% CTx (CrossLaps) (None)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	5	100.0	0.0	0.0	0.28	13.1	e*

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

P1NP

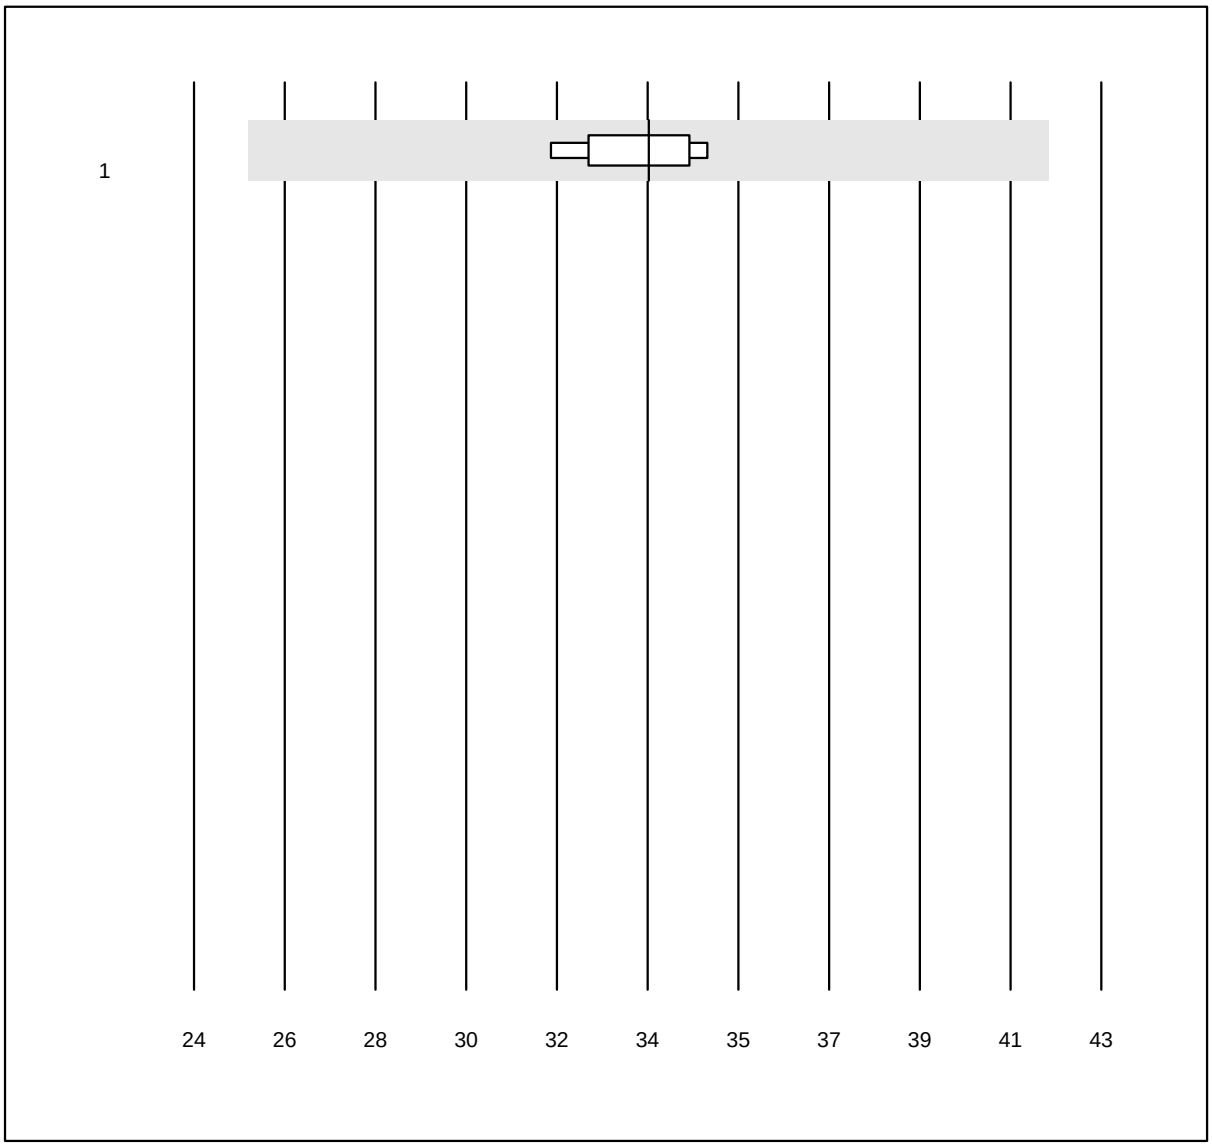


MQ Toleranz: 25%

P1NP (ng/ml)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	4	100.0	0.0	0.0	33.5	3.3	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Sang occulte qn

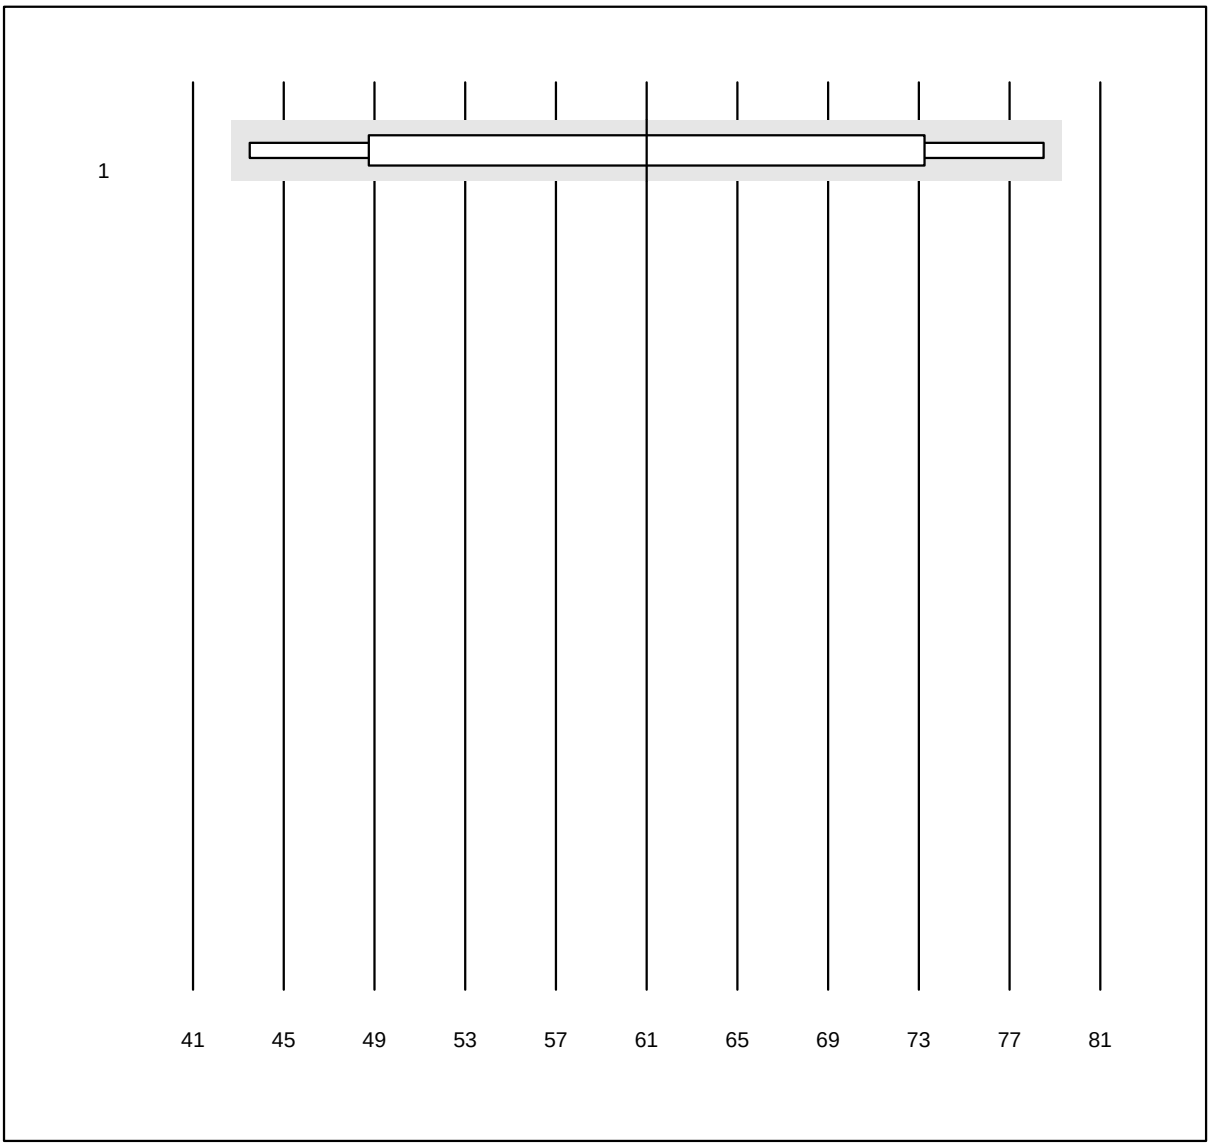


QUALAB Toleranz: 30%

Sang occulte qn (ng/ml)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	OC-Sensor	10	60.0	0.0	40.0	61	22.2	a*

Amylase

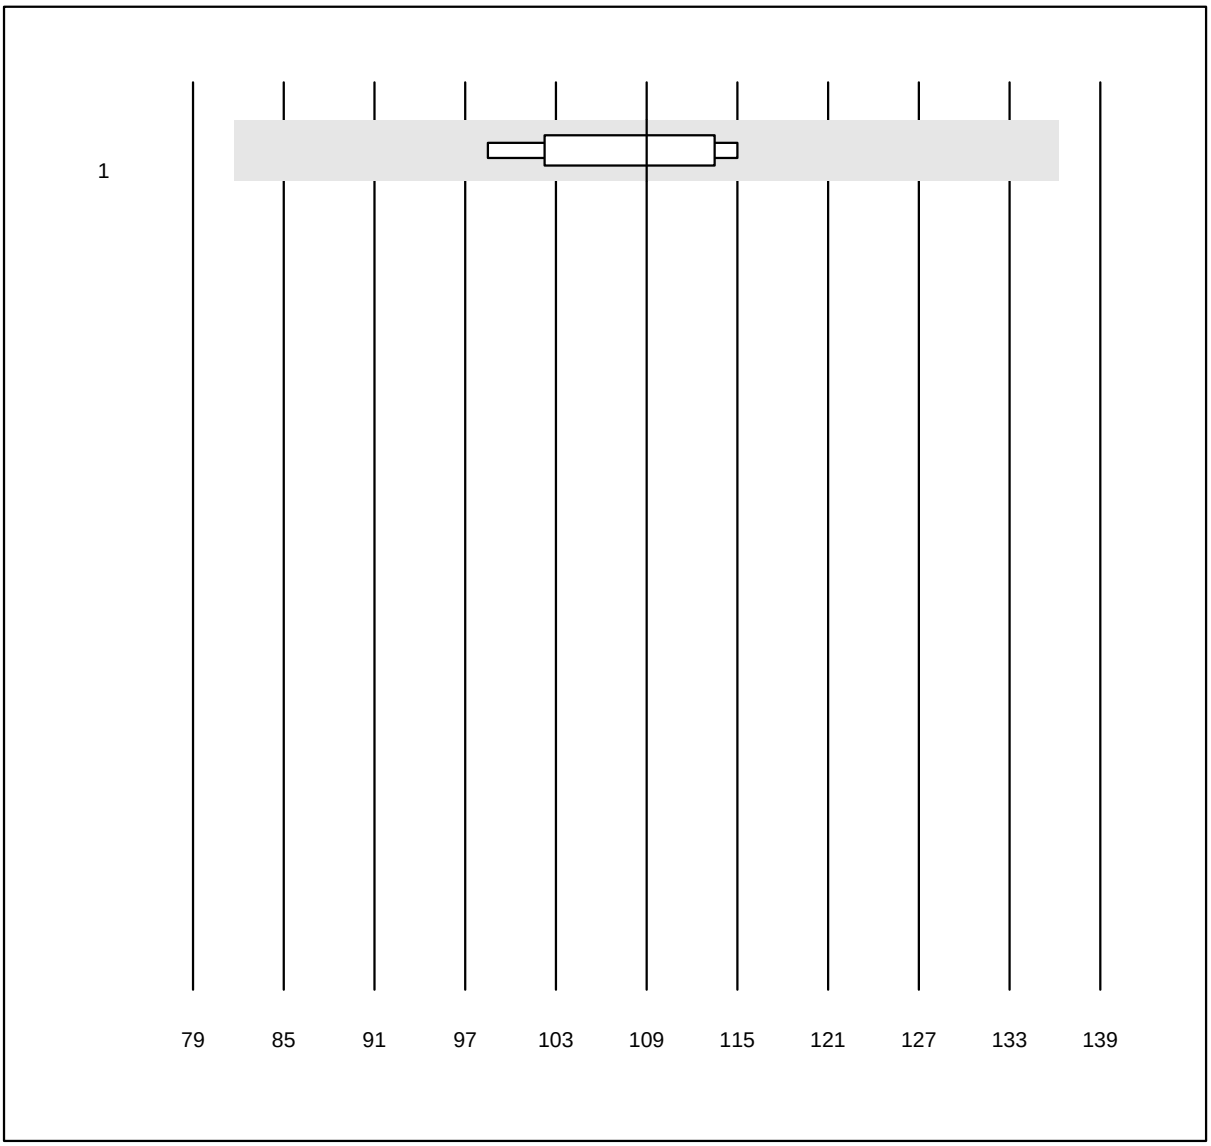


MQ Toleranz: 25%

Amylase (U/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	IFCC	4	100.0	0.0	0.0	109	5.5	e

Calcium

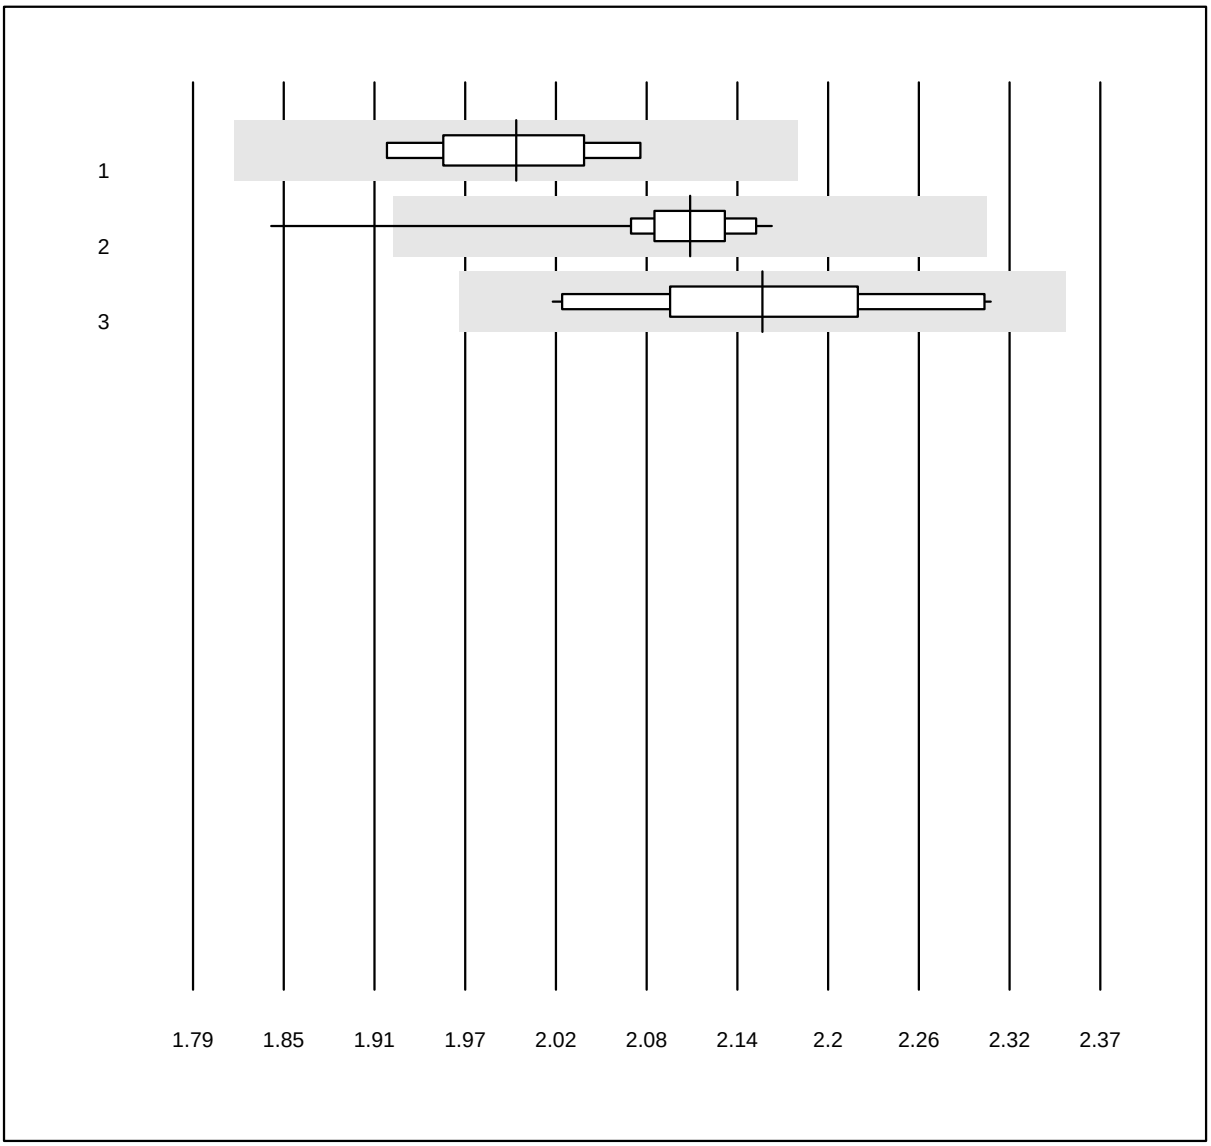


MQ Toleranz: 9%
(< 2.0: +/- 0.18 mmol/l)

Calcium (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	5	100.0	0.0	0.0	2.00	2.5	e*
2	Roche	29	96.6	3.4	0.0	2.11	2.8	e
3	Autres méthodes	10	100.0	0.0	0.0	2.15	4.0	e*

Chlorures

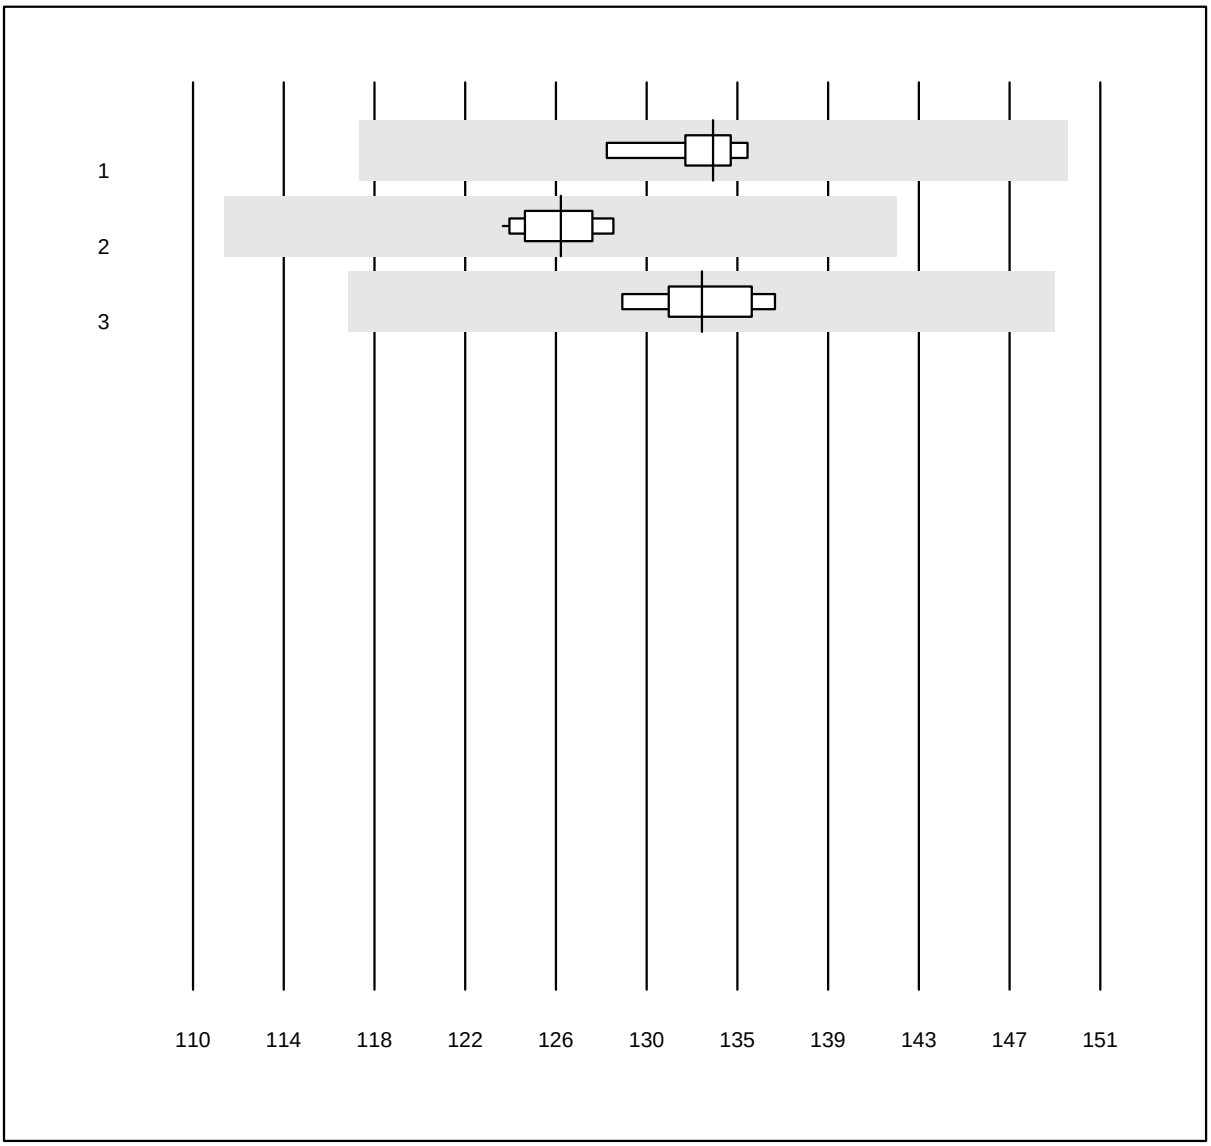


MQ Toleranz: 12%

Chlorures (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	8	100.0	0.0	0.0	134	1.4	e
2	Roche	22	100.0	0.0	0.0	127	1.3	e
3	ISE direct	6	100.0	0.0	0.0	133	1.6	e

Protéines

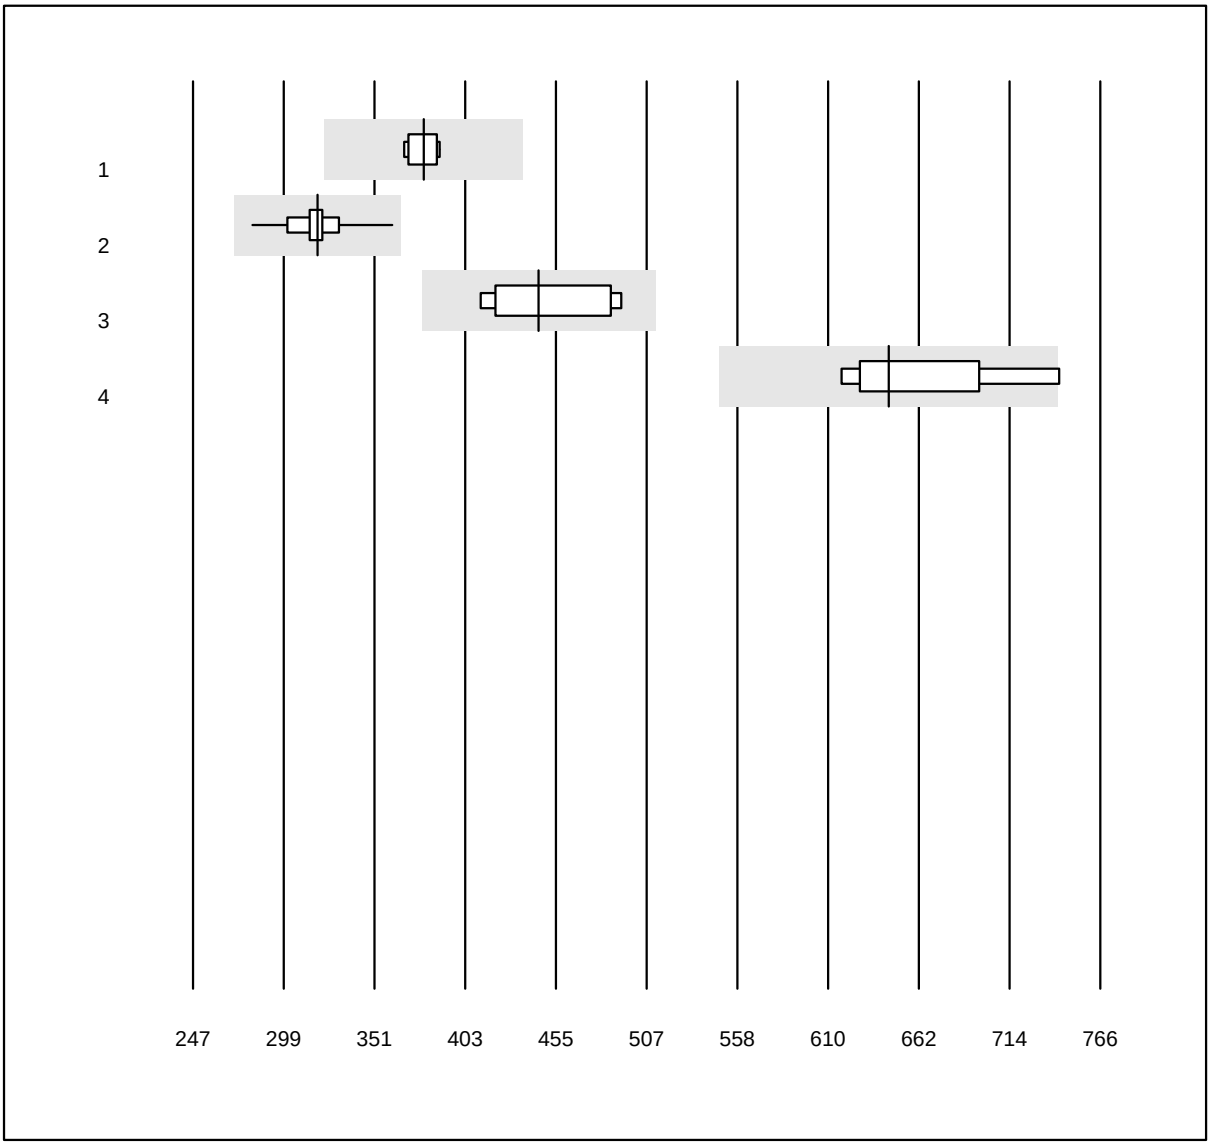


QUALAB Toleranz: 15%

Protéines (mg/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	8	100.0	0.0	0.0	379.0	2.2	e
2	Roche	34	100.0	0.0	0.0	318.2	4.2	e
3	Siemens	7	100.0	0.0	0.0	444.7	7.0	e*
4	Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	645.0	5.8	e*

Glucose

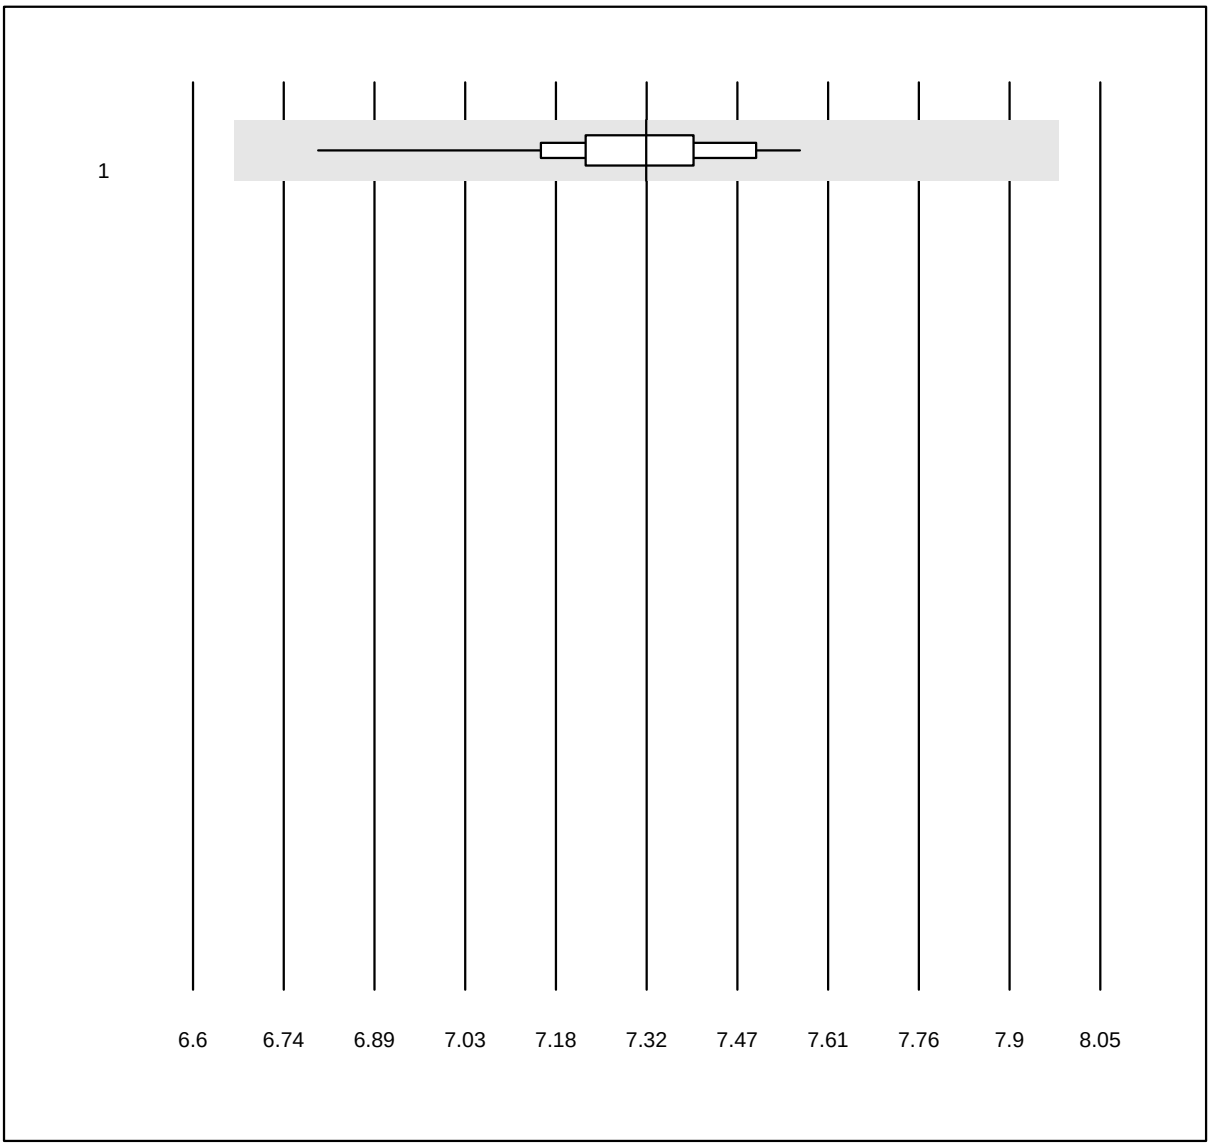


QUALAB Toleranz: 9% Glucose (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Chimie humide	32	100.0	0.0	0.0	7.3	2.2	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Acide urique

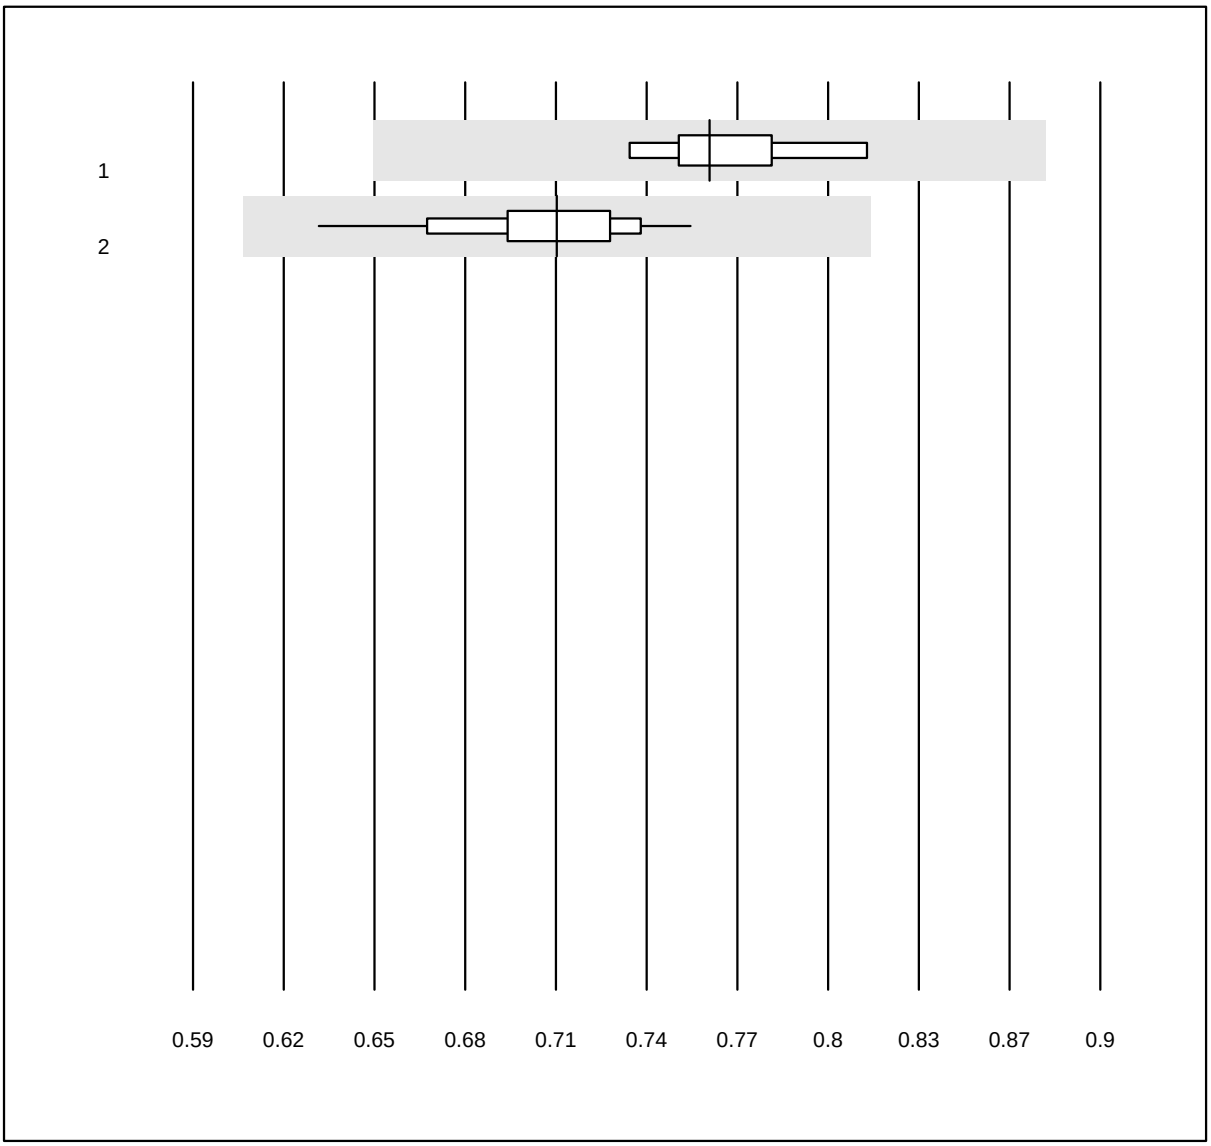


MQ Toleranz: 15%

Acide urique (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Siemens	6	100.0	0.0	0.0	0.77	3.0	e
2	Chimie humide	29	100.0	0.0	0.0	0.71	3.9	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Urée

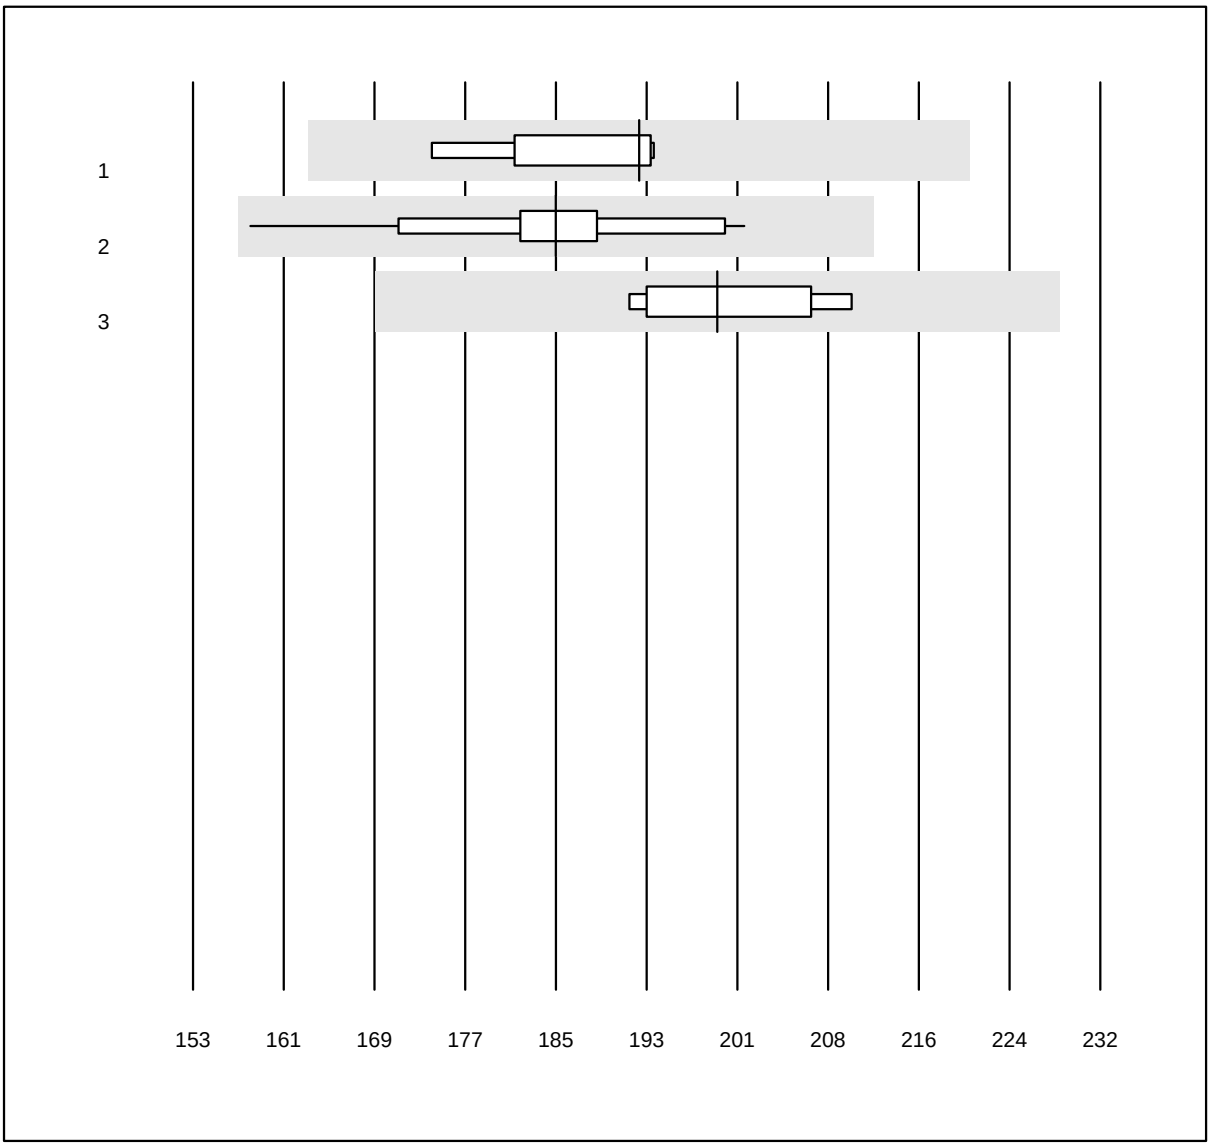


MQ Toleranz: 15%

Urée (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Siemens	6	83.3	0.0	16.7	192	3.6	e
2	Chimie humide	38	100.0	0.0	0.0	185	4.8	e
3	Vitros	4	100.0	0.0	0.0	199	3.8	e*

Potassium

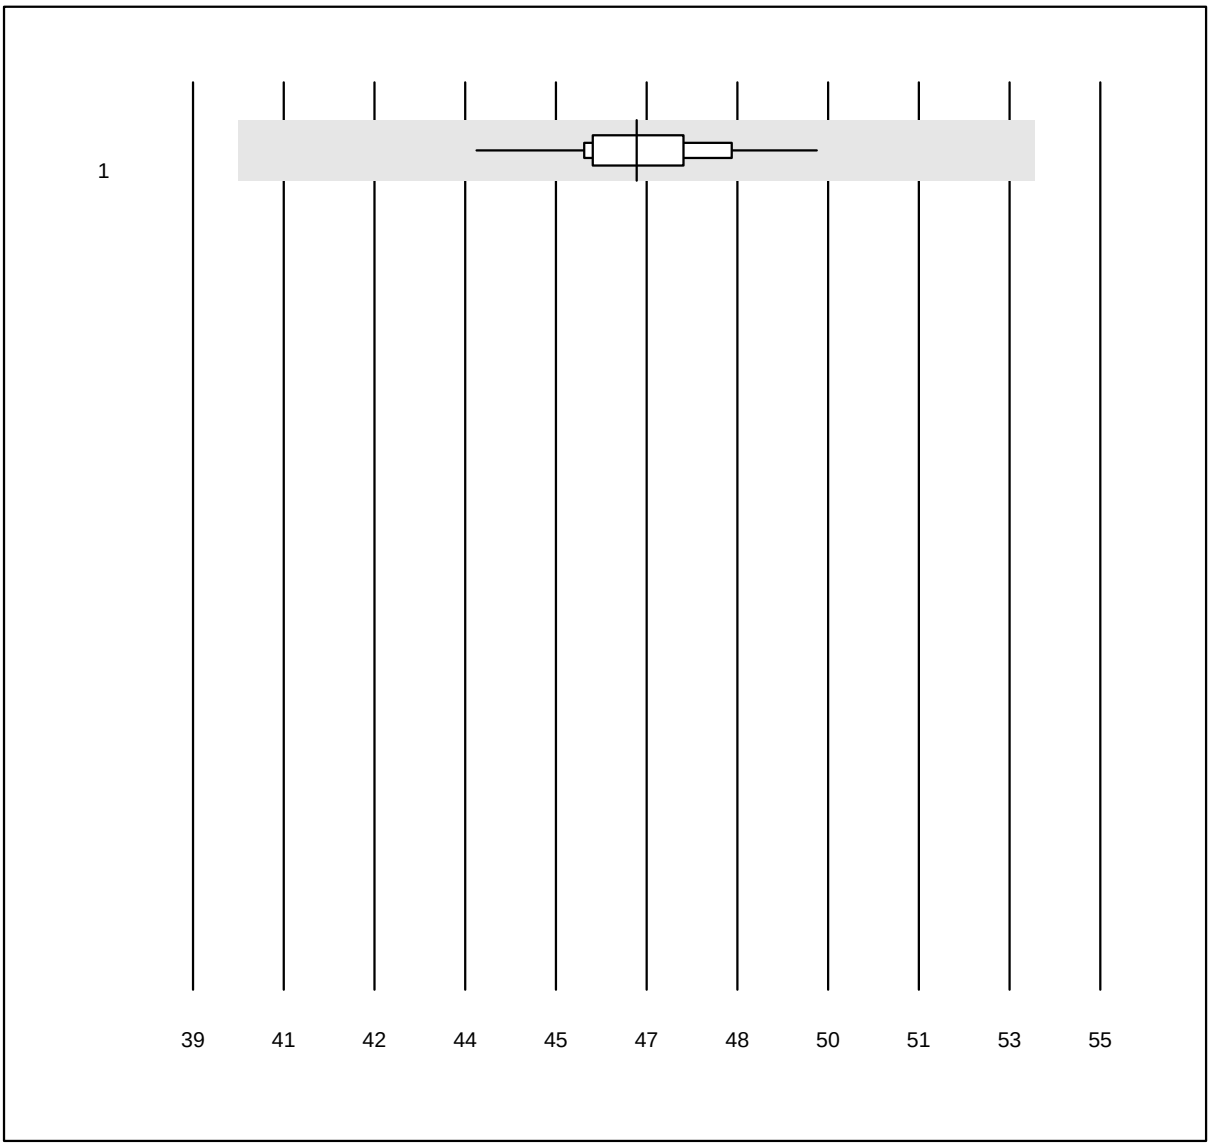


MQ Toleranz: 15%

Potassium (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	toutes les méthodes	49	100.0	0.0	0.0	47	2.3	e

Magnésium

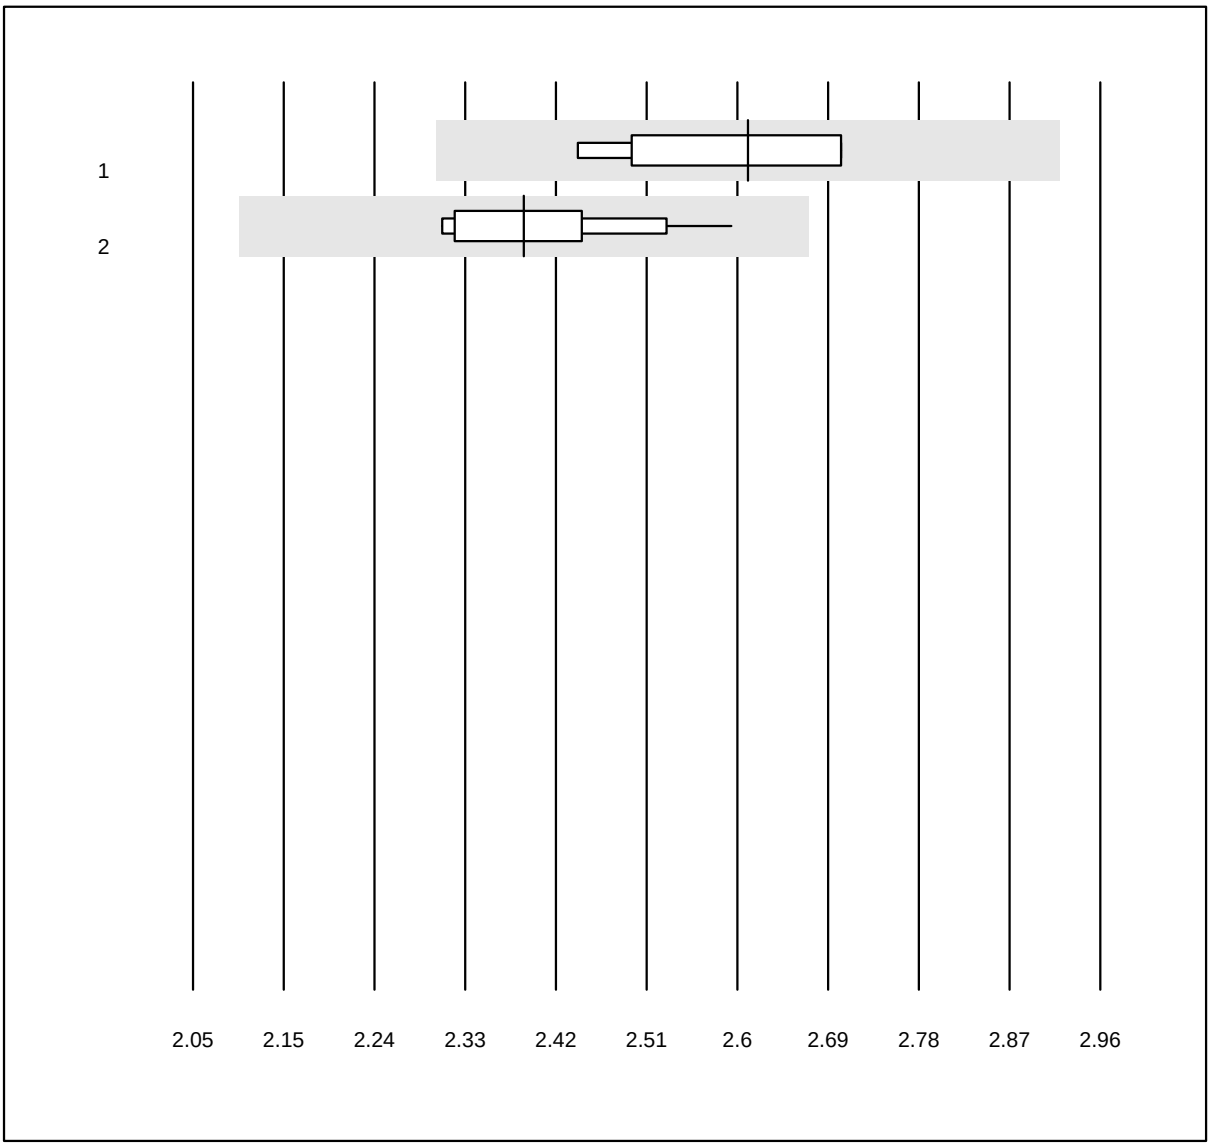


MQ Toleranz: 12%

Magnésium (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	AAS	5	100.0	0.0	0.0	2.61	4.1	e*
2	Chimie humide	24	100.0	0.0	0.0	2.38	3.5	e

Sodium

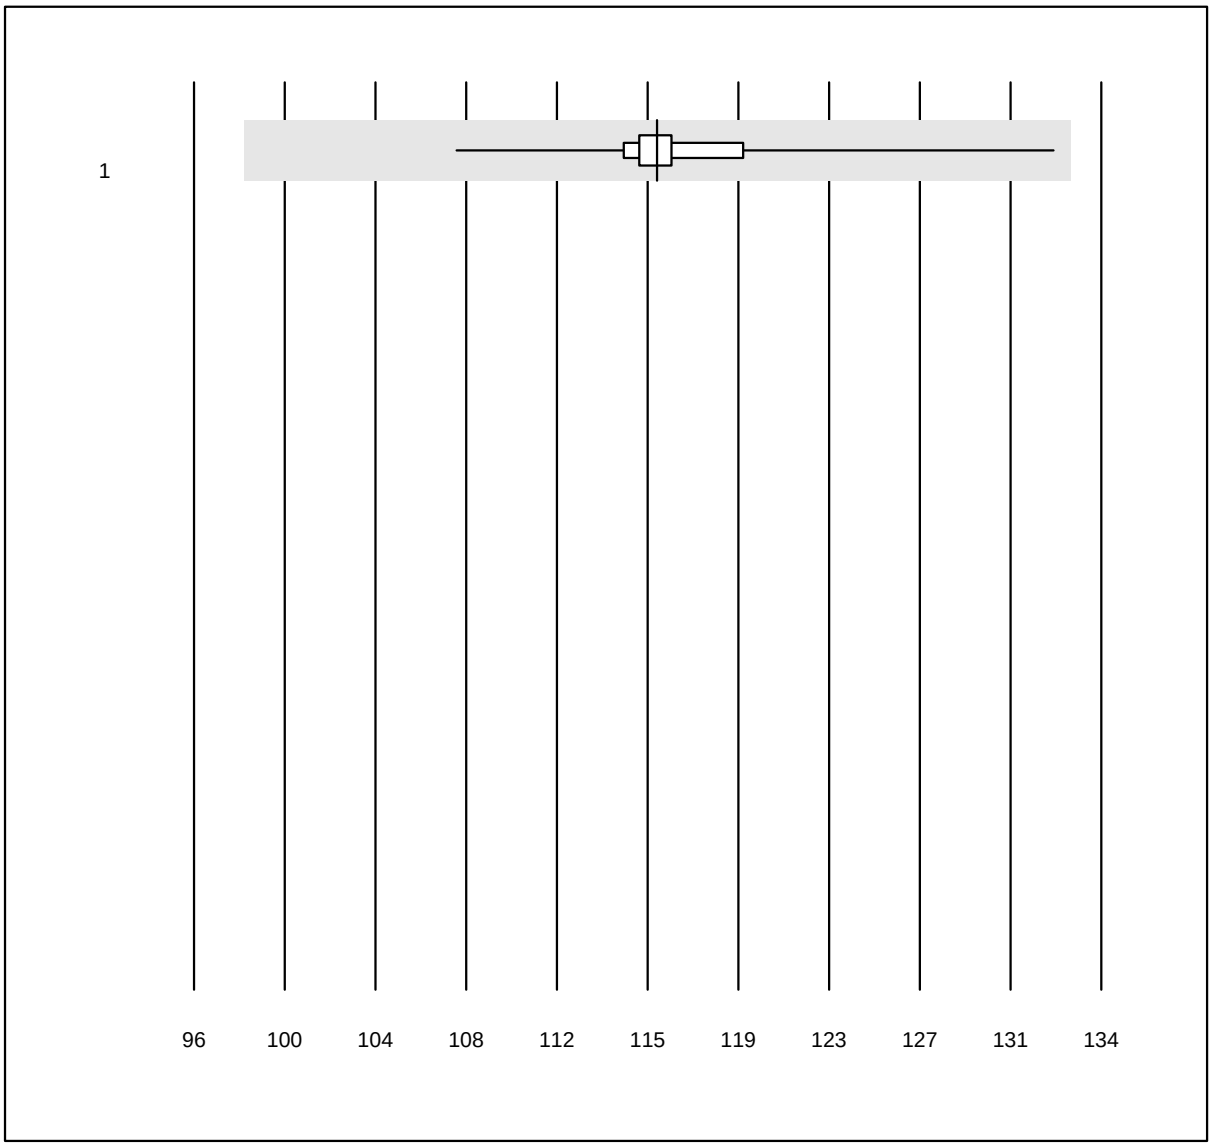


MQ Toleranz: 15%

Sodium (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	toutes les méthodes	49	100.0	0.0	0.0	115	3.0	e

Osmolalité

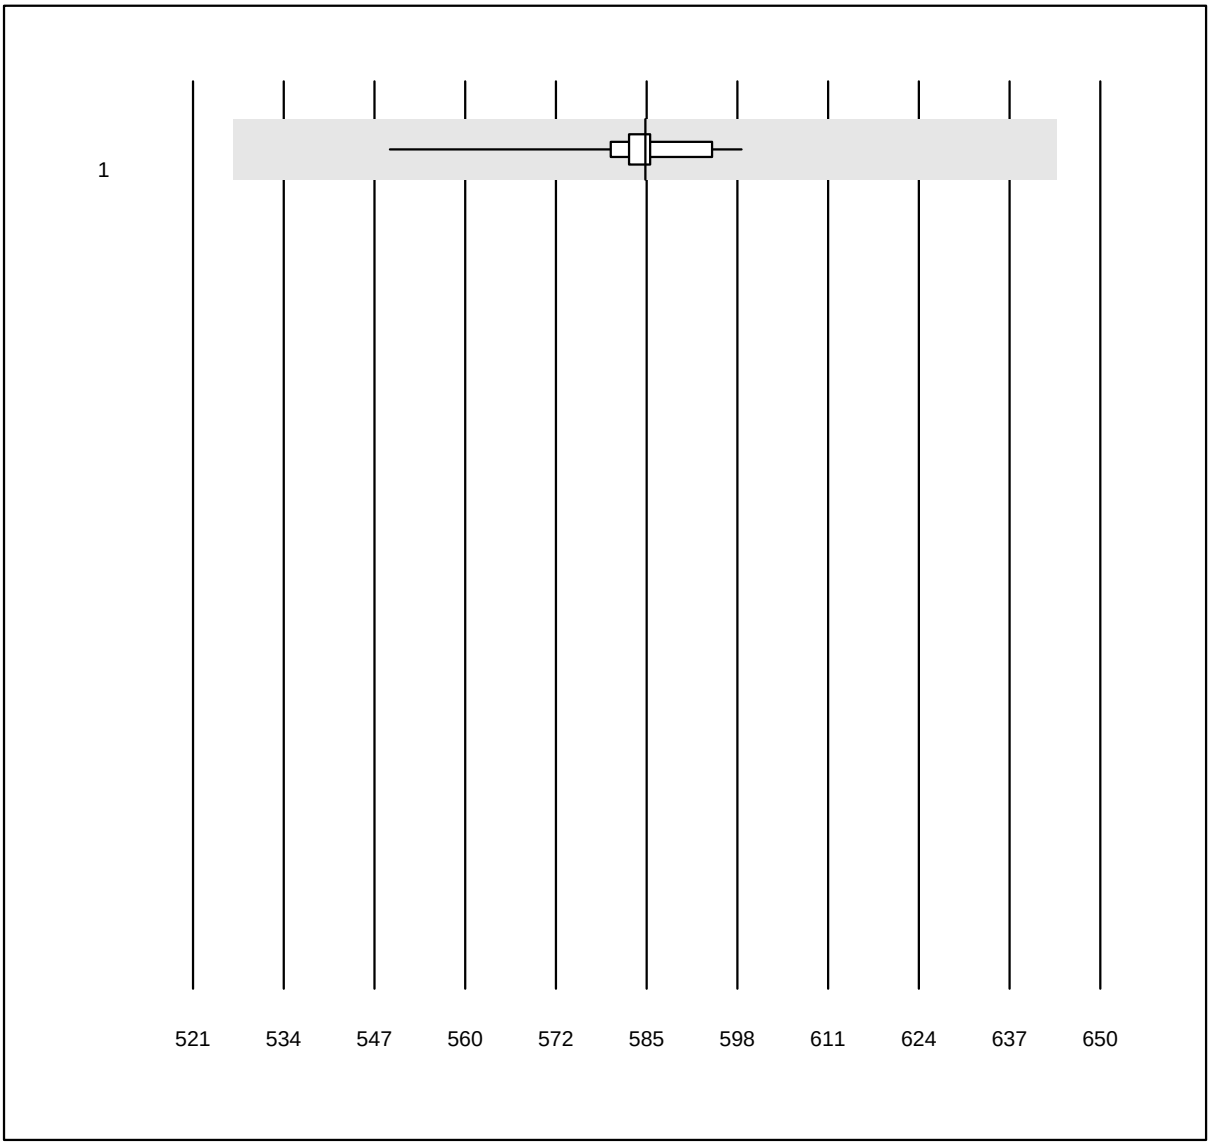


MQ Toleranz: 10%

Osmolalité (mosm/kg)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Cryoscopie	24	95.8	0.0	4.2	585	1.5	e

Panc. Amylase-urine

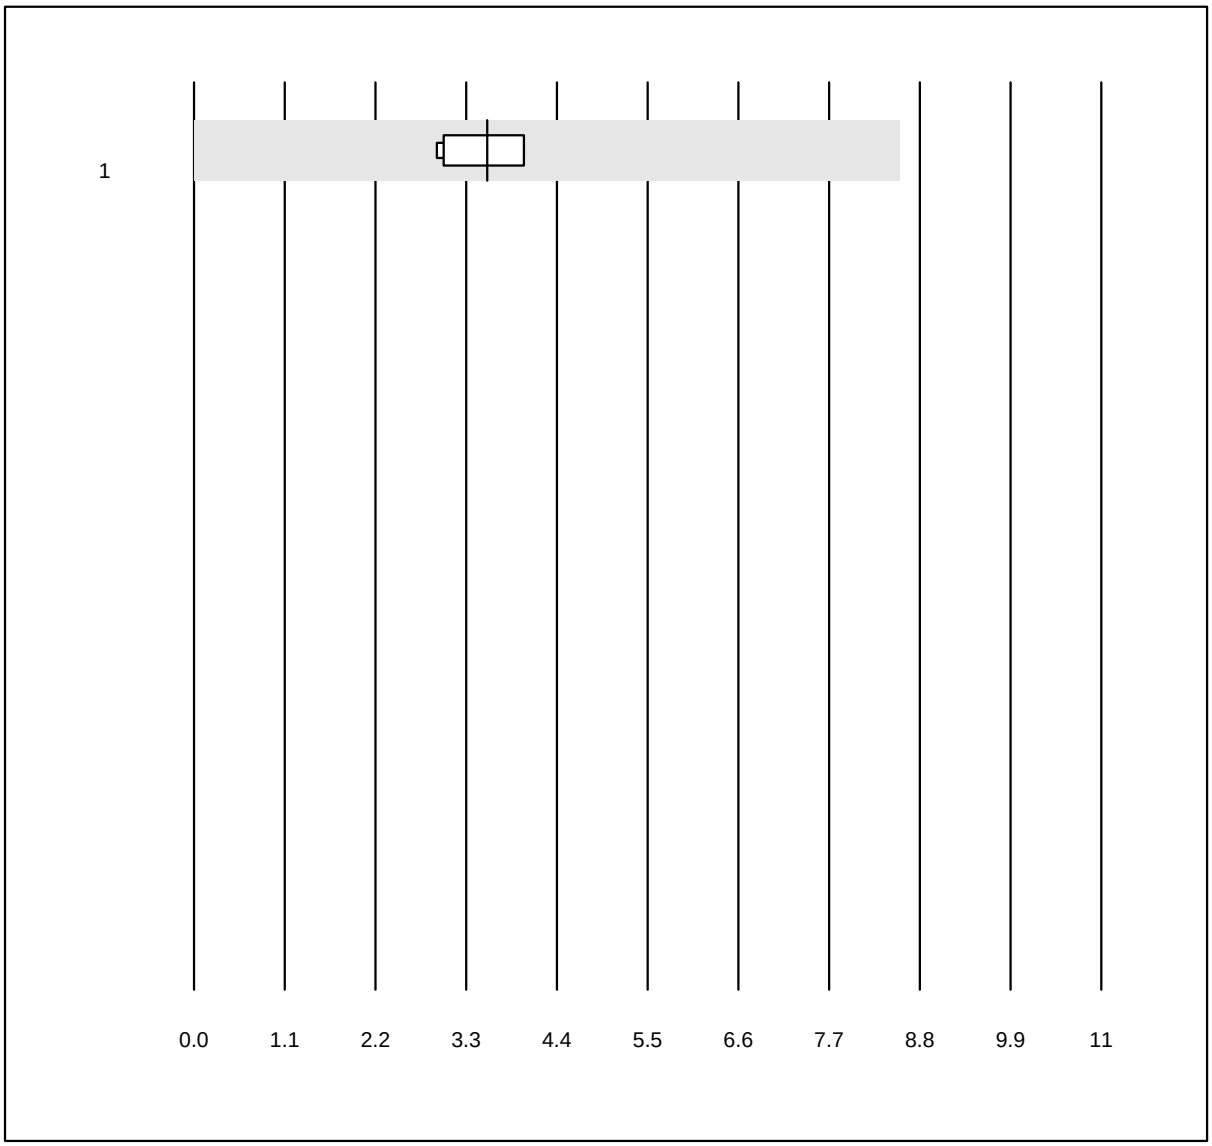


MQ Toleranz: 18%
(< 25.0: +/- 5.0 U/l)

Panc. Amylase-urine (U/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	IFCC	4	100.0	0.0	0.0	3.6	15.5	e

Phosphate

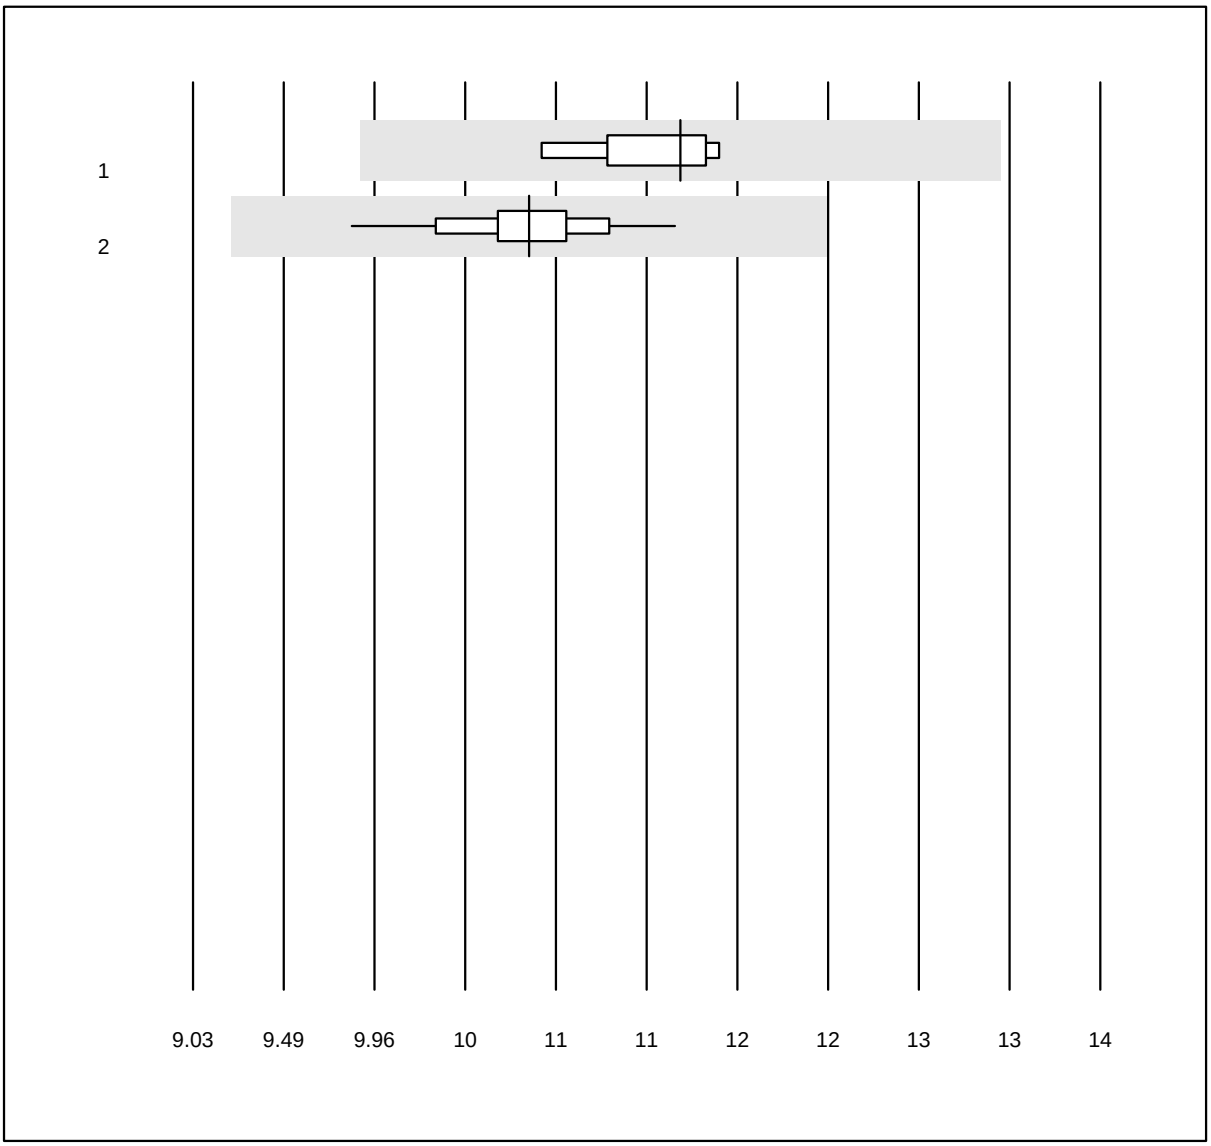


MQ Toleranz: 15%

Phosphate (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Siemens	5	100.0	0.0	0.0	11.7	2.8	e
2	Chimie humide	28	100.0	0.0	0.0	10.9	3.4	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Gravité specifique

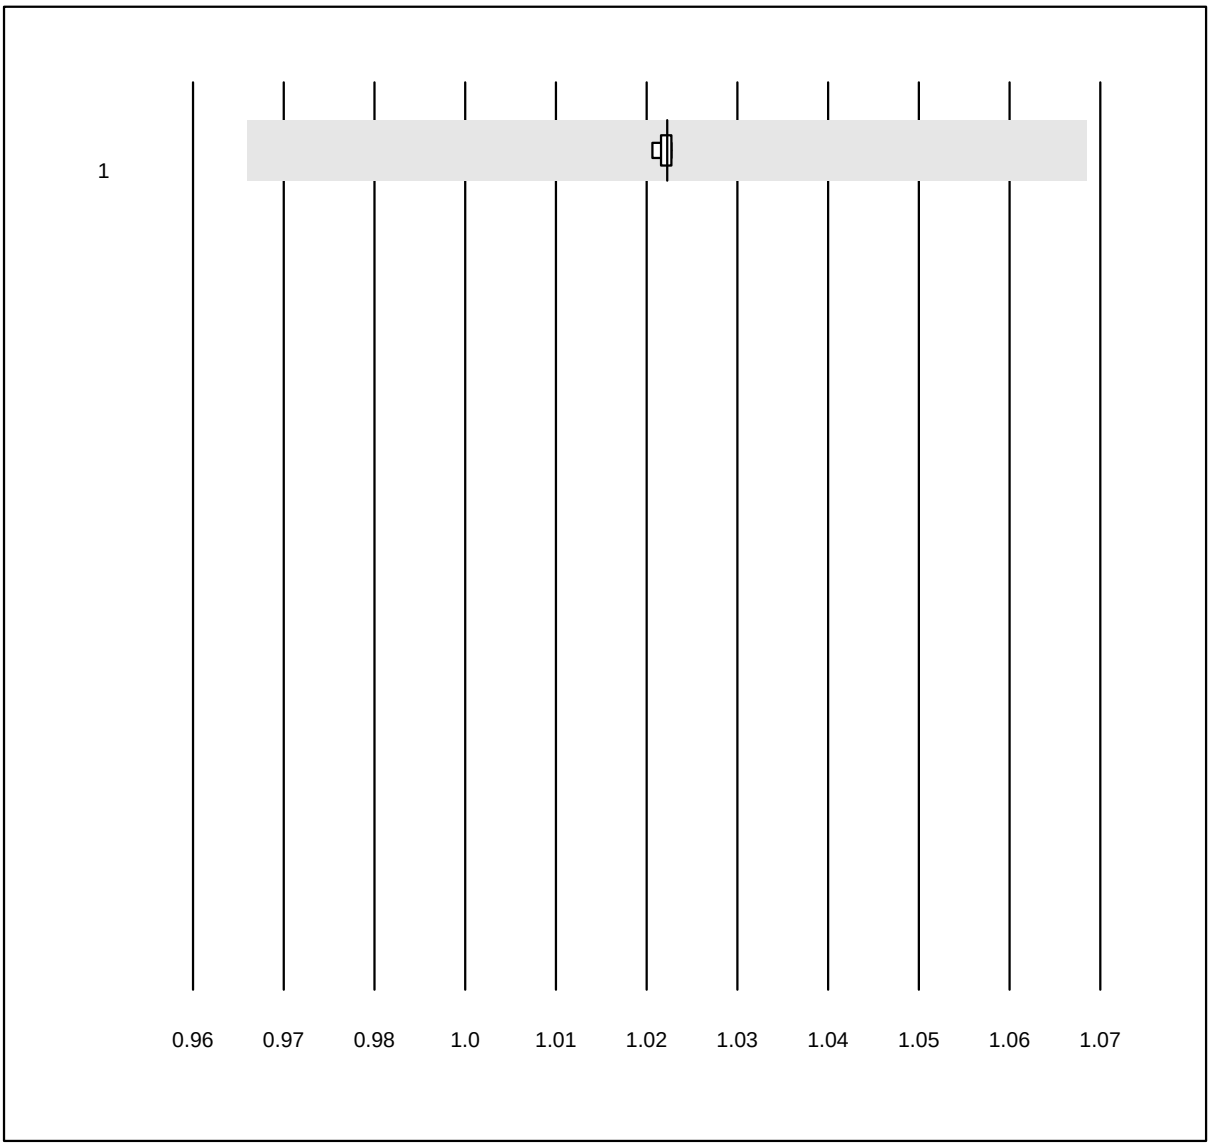


MQ Toleranz: 5%

Gravité specifique (g/ml)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Refraktometer	6	100.0	0.0	0.0	1.018	0.1	e

Microalbumine

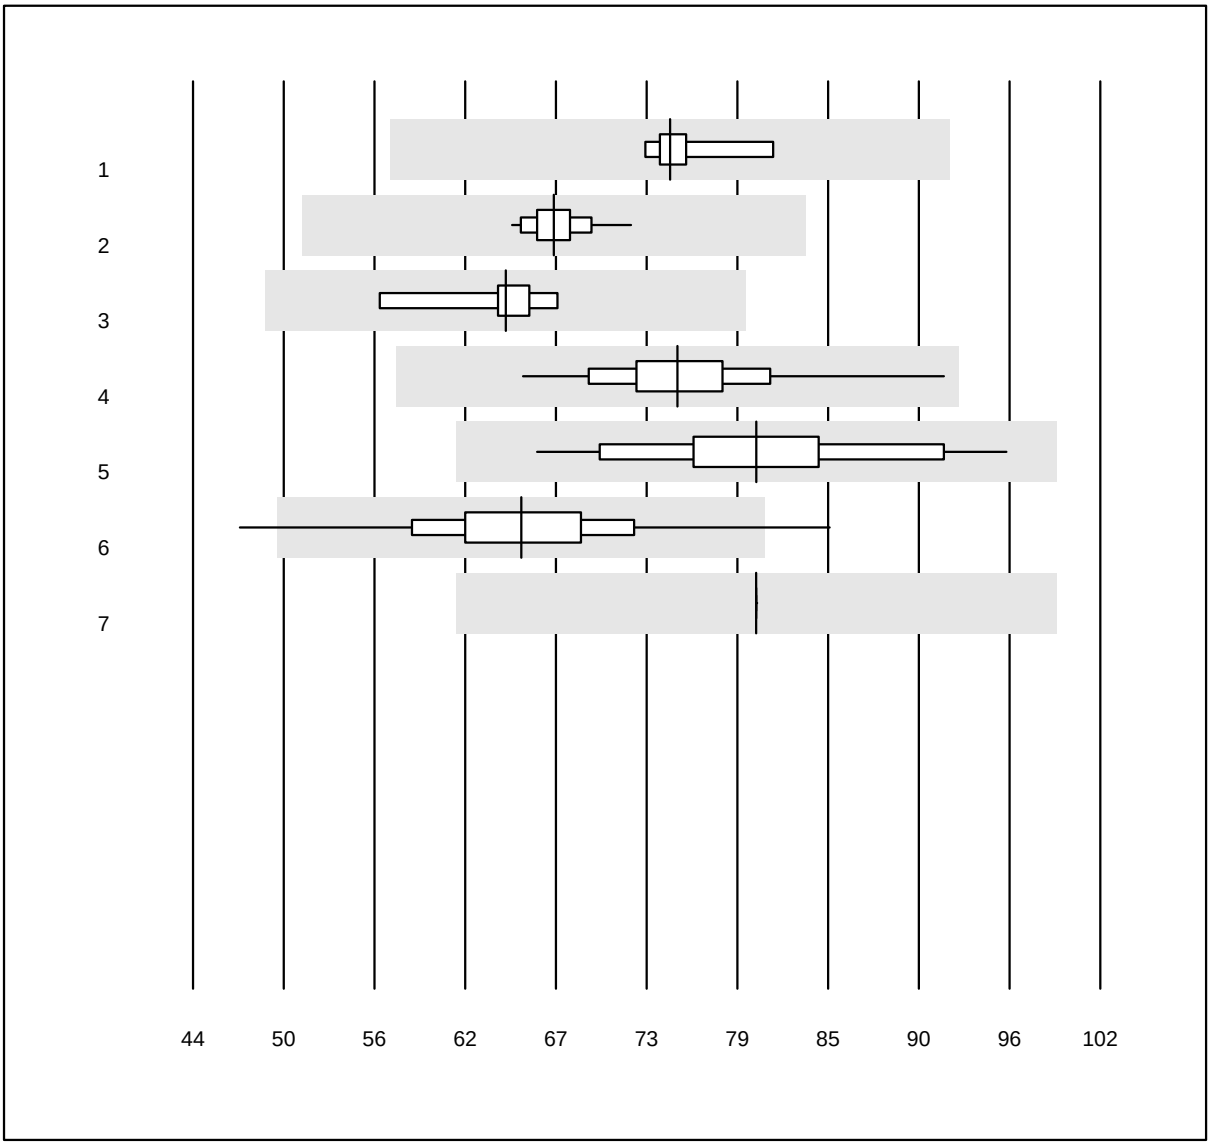


QUALAB Toleranz: 24%

Microalbumine (mg/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	8	100.0	0.0	0.0	74.5	3.1	e
2	Roche	31	100.0	0.0	0.0	67.1	2.6	e
3	Siemens	8	87.5	0.0	12.5	64.0	4.9	a
4	DCA Vantage	171	98.8	0.0	1.2	75.0	5.9	e
5	AFIAS	19	100.0	0.0	0.0	80.0	9.1	e
6	Afinion	581	96.6	1.2	2.2	65.0	9.0	e
7	Autres méthodes	10	80.0	0.0	20.0	80.0	0.0	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Microalbumine sq

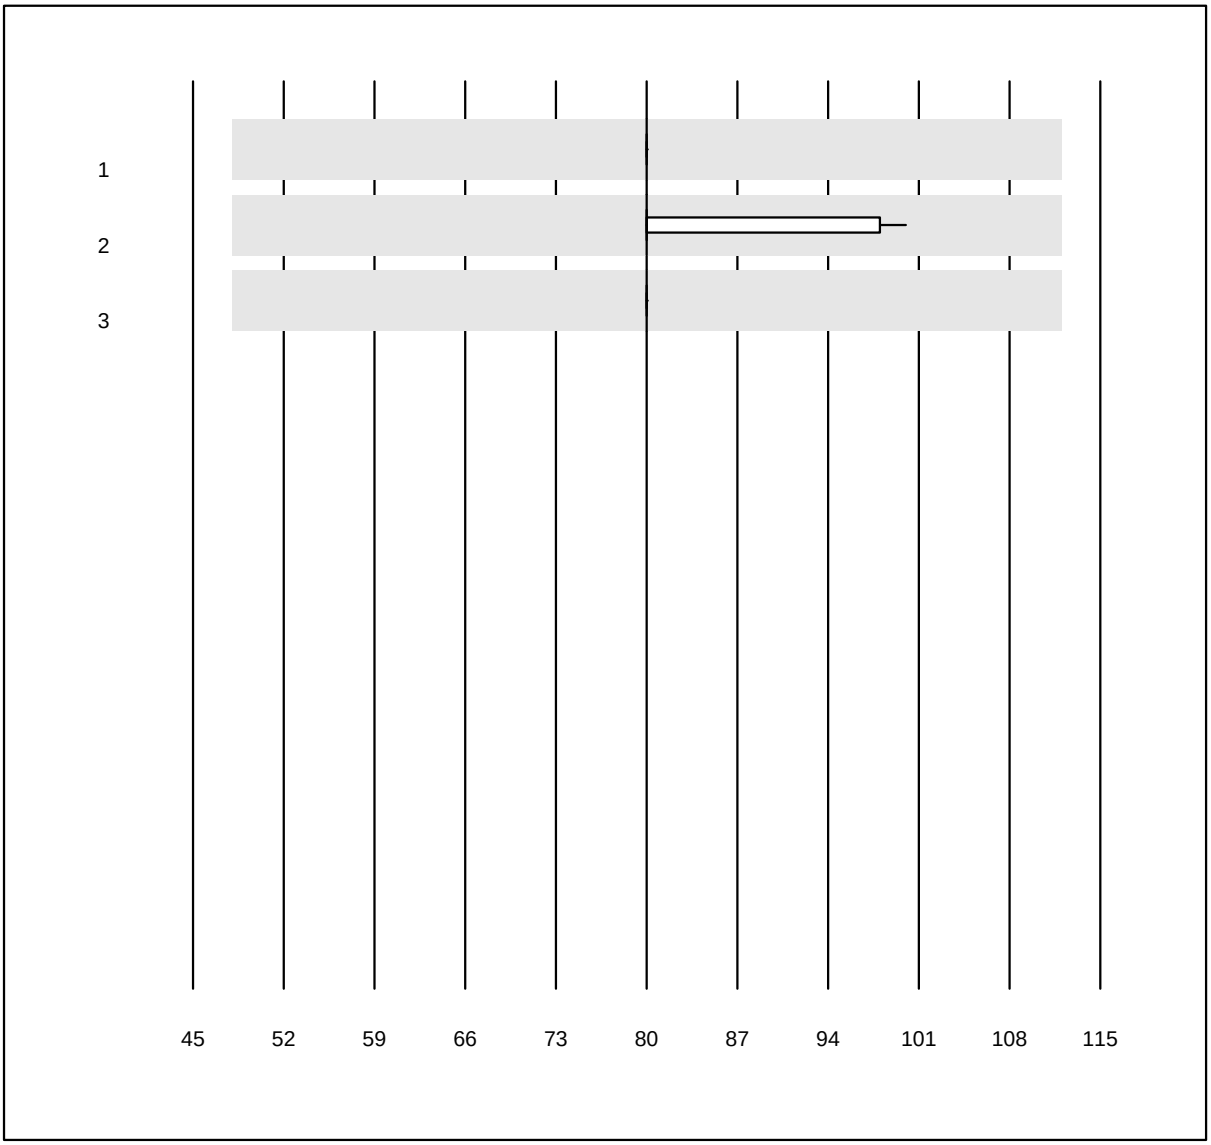


QUALAB Toleranz: 40%

Microalbumine sq (mg/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Siemens Clinitek	21	95.2	0.0	4.8	80.0	0.0	e
2	Aution	22	90.9	0.0	9.1	80.0	7.5	e
3	Sysmex U	20	75.0	0.0	25.0	80.0	0.0	e

Créatinine urine

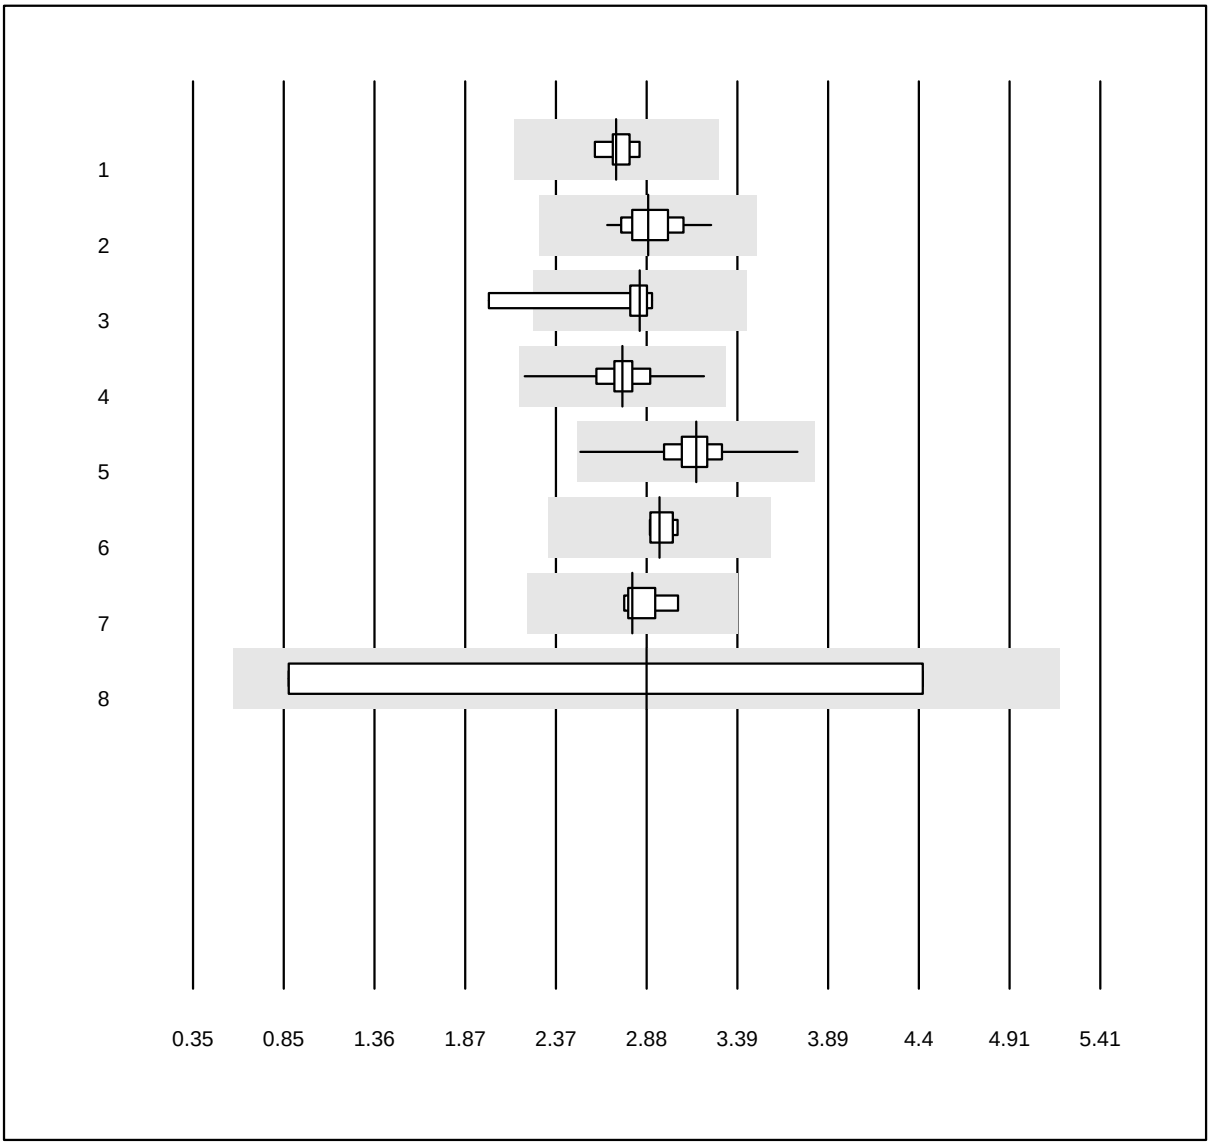


QUALAB Toleranz: 21%

Créatinine urine (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Abbott	8	100.0	0.0	0.0	2.7	2.7	e
2	Roche	38	100.0	0.0	0.0	2.9	4.7	e
3	Siemens	10	80.0	10.0	10.0	2.8	10.3	e*
4	Afinion	574	99.3	0.0	0.7	2.7	4.9	e
5	DCA Vantage	171	95.3	0.0	4.7	3.2	5.2	e
6	Vitros	4	100.0	0.0	0.0	3.0	2.3	e
7	Chimie humide	4	100.0	0.0	0.0	2.8	3.2	e
8	Autres méthodes	9	100.0	0.0	0.0	2.9	85.7	a*

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Créatinine urine sq

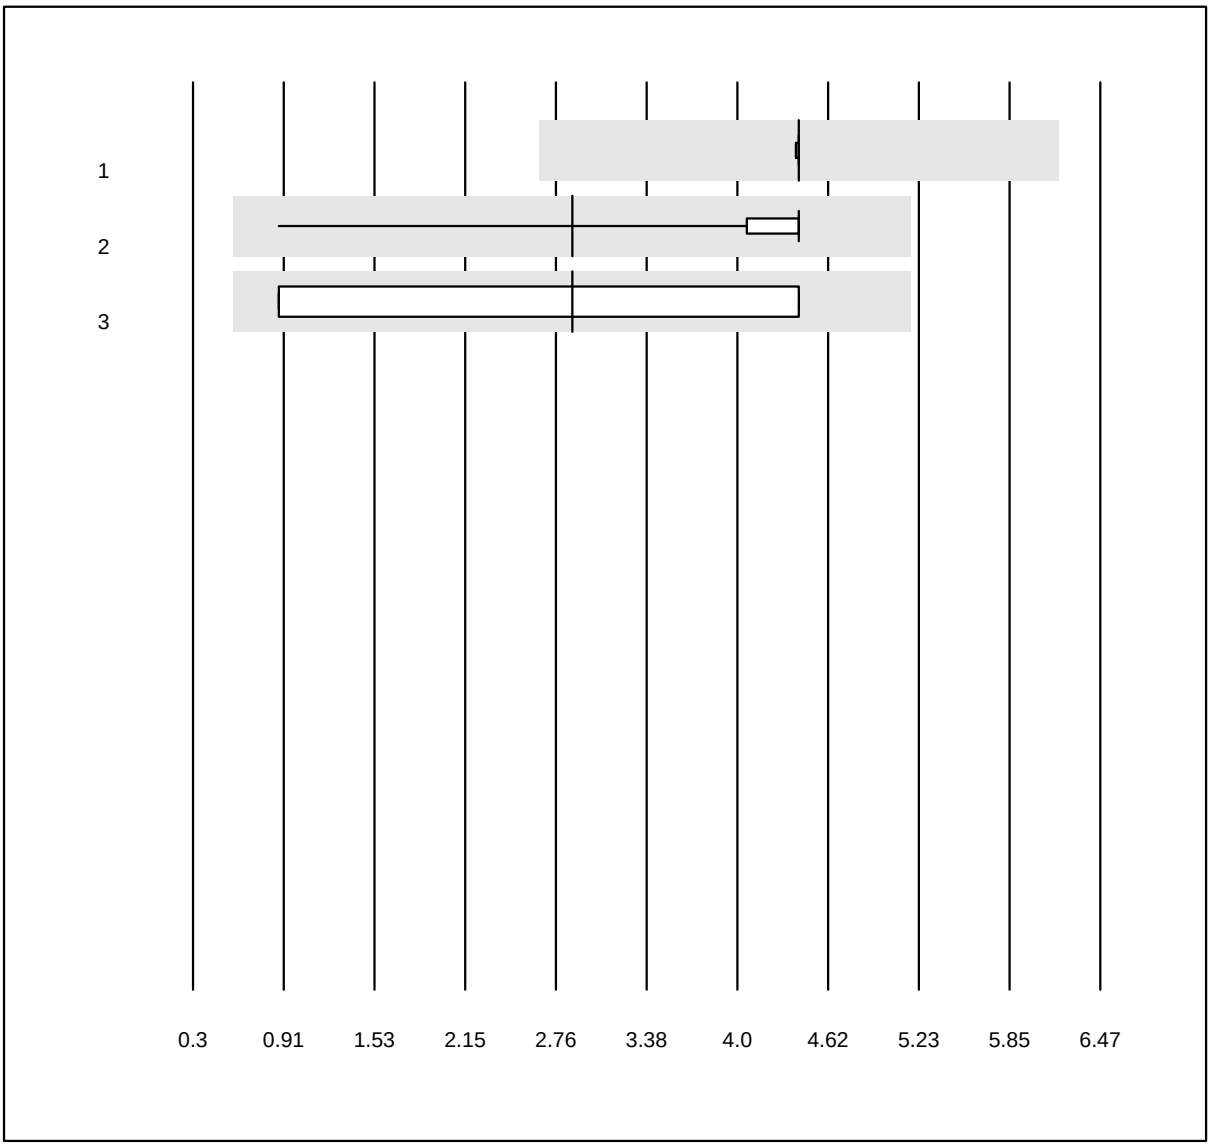


MQ Toleranz: 40%

Créatinine urine sq (mmol/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Siemens Clinitek	21	85.7	0.0	14.3	4.4	0.2	e
2	Aution	22	81.8	0.0	18.2	2.9	19.7	a
3	Sysmex U	18	83.3	0.0	16.7	2.9	65.9	a*

Erythrocytes

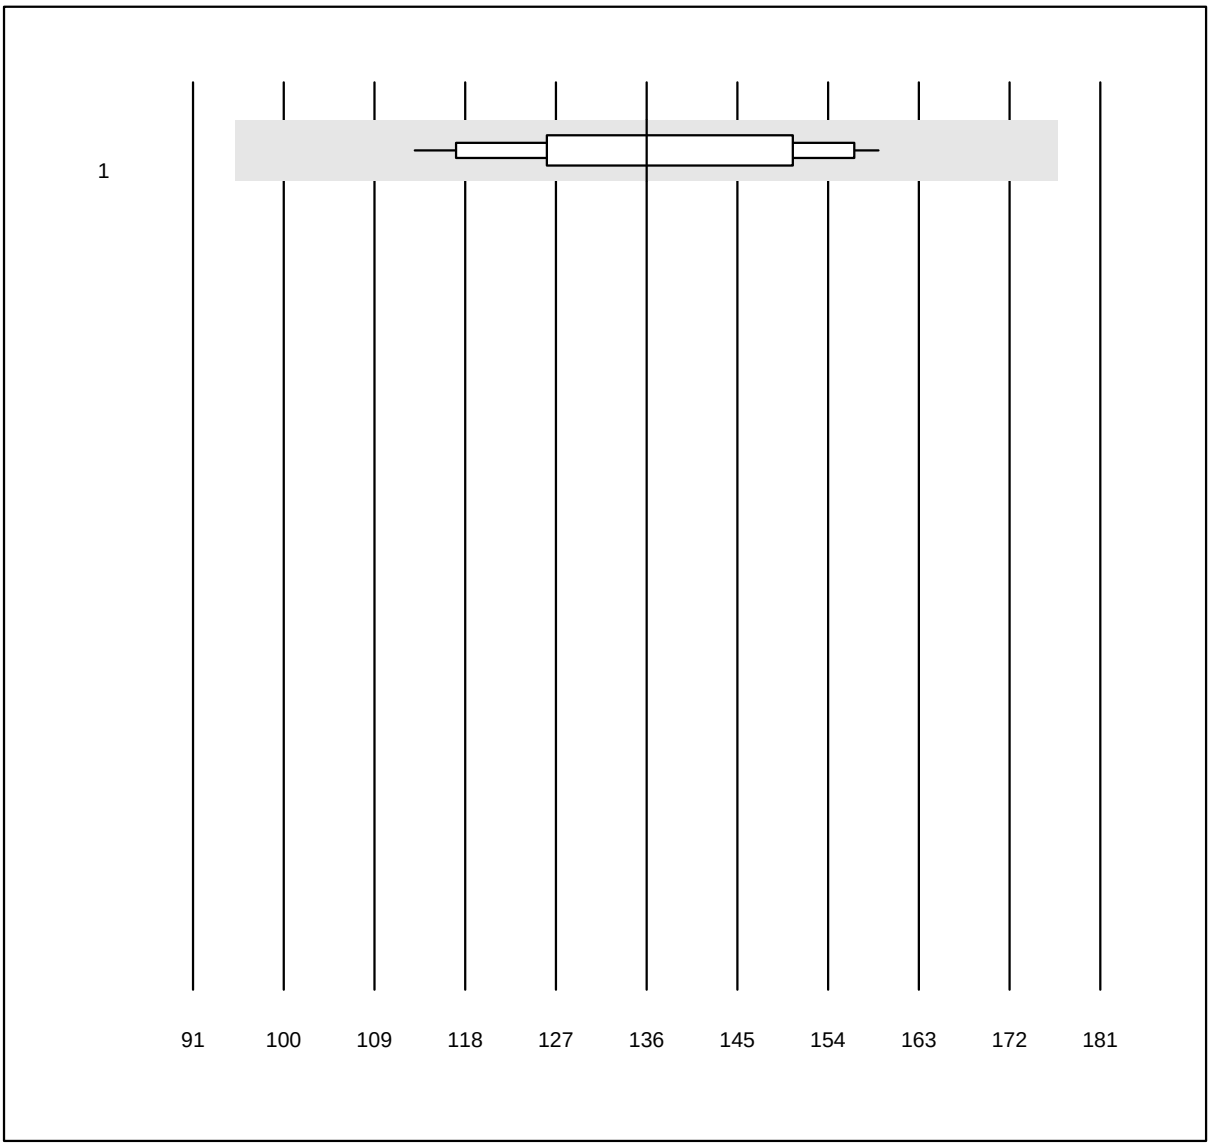


MQ Toleranz: 30%

Erythrocytes (/µl)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Sysmex	20	100.0	0.0	0.0	136	10.2	a

2 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

CMV NAT qn

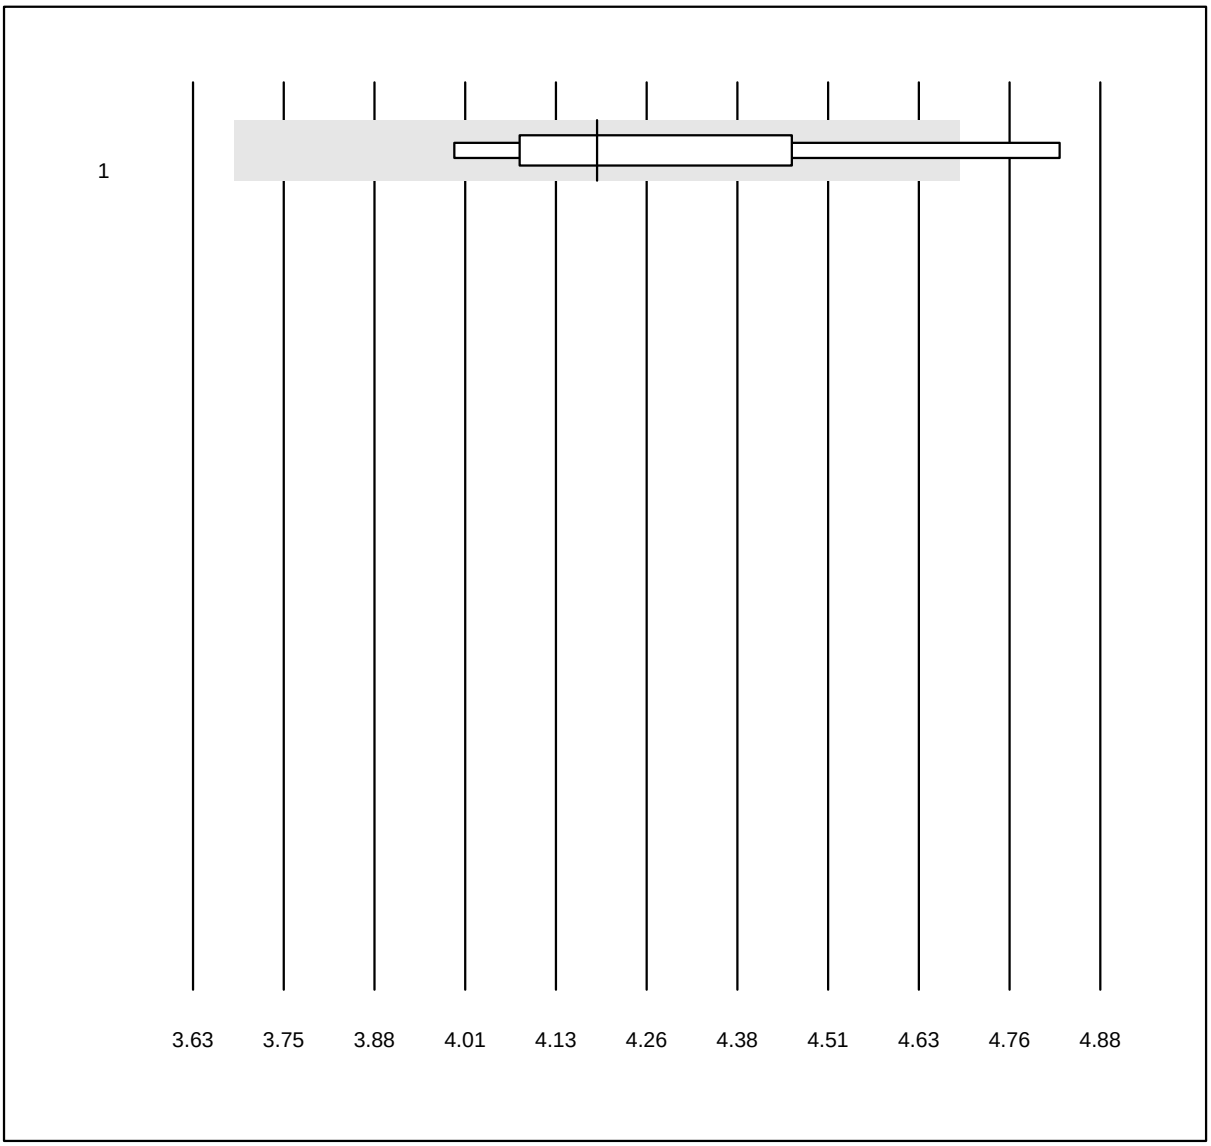


QUALAB Toleranz: 0%
(< 15.0: +/- 0.5 Log10 IU/ml)

CMV NAT qn (Log10 IU/ml)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	4.19	5.7	e*

EBV NAT qn

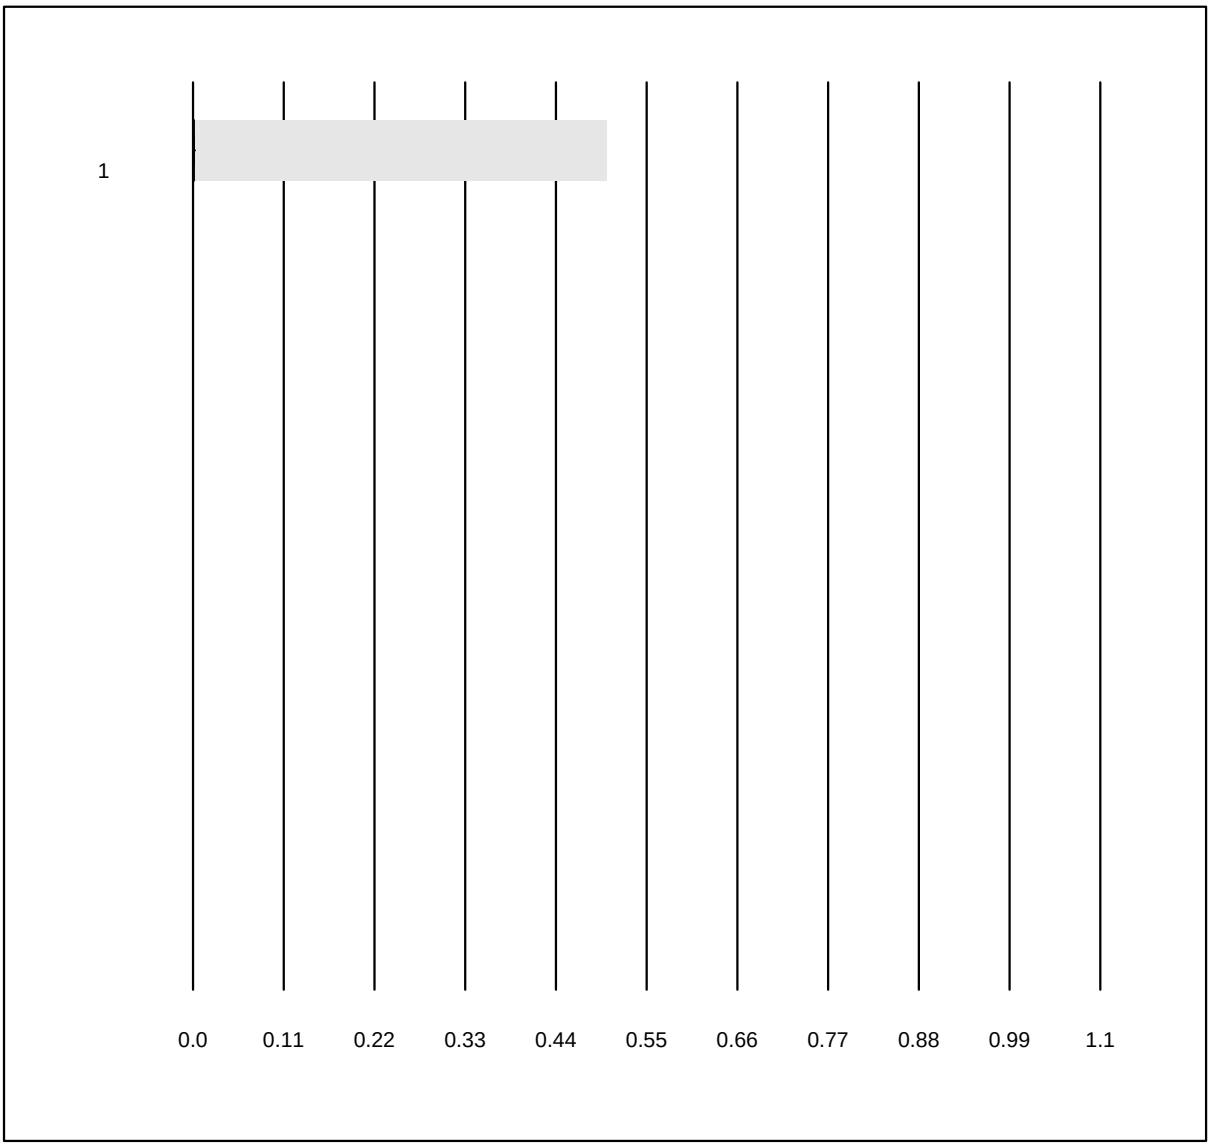


QUALAB Toleranz: 0%
(< 15.0: +/- 0.5 Log10 IU/ml)

EBV NAT qn (Log10 IU/ml)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	toutes les méthodes	5	100.0	0.0	0.0	0.00	0.0	e

HBV NAT qn

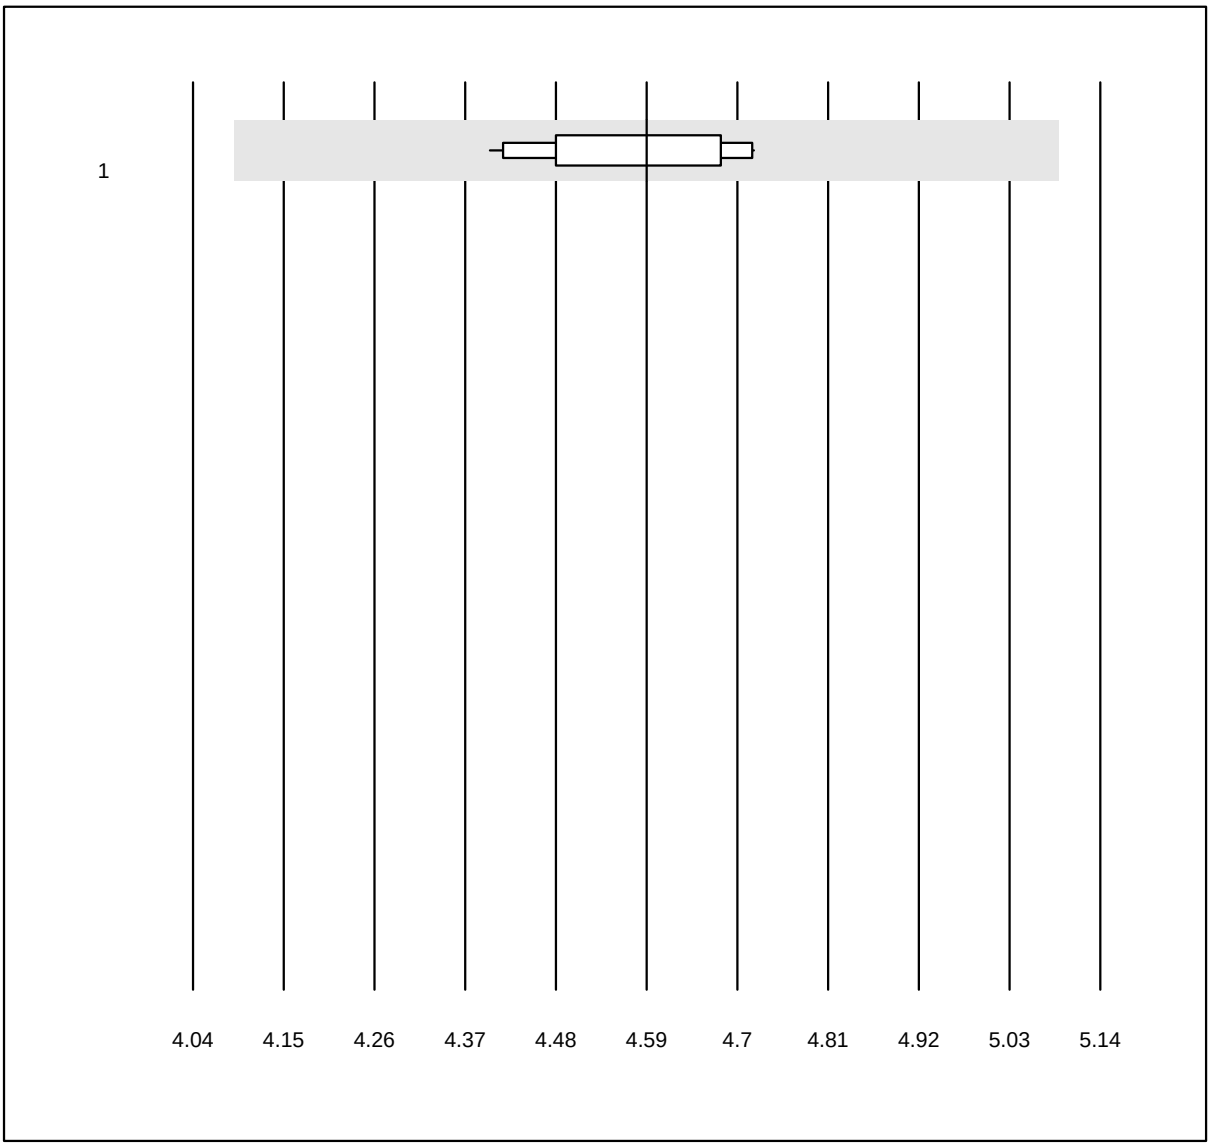


QUALAB Toleranz: 0%
(< 15.0: +/- 0.5 Log10 IU/ml)

HBV NAT qn (Log10 IU/ml)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	toutes les méthodes	11	100.0	0.0	0.0	4.59	2.3	e

HCV NAT qn

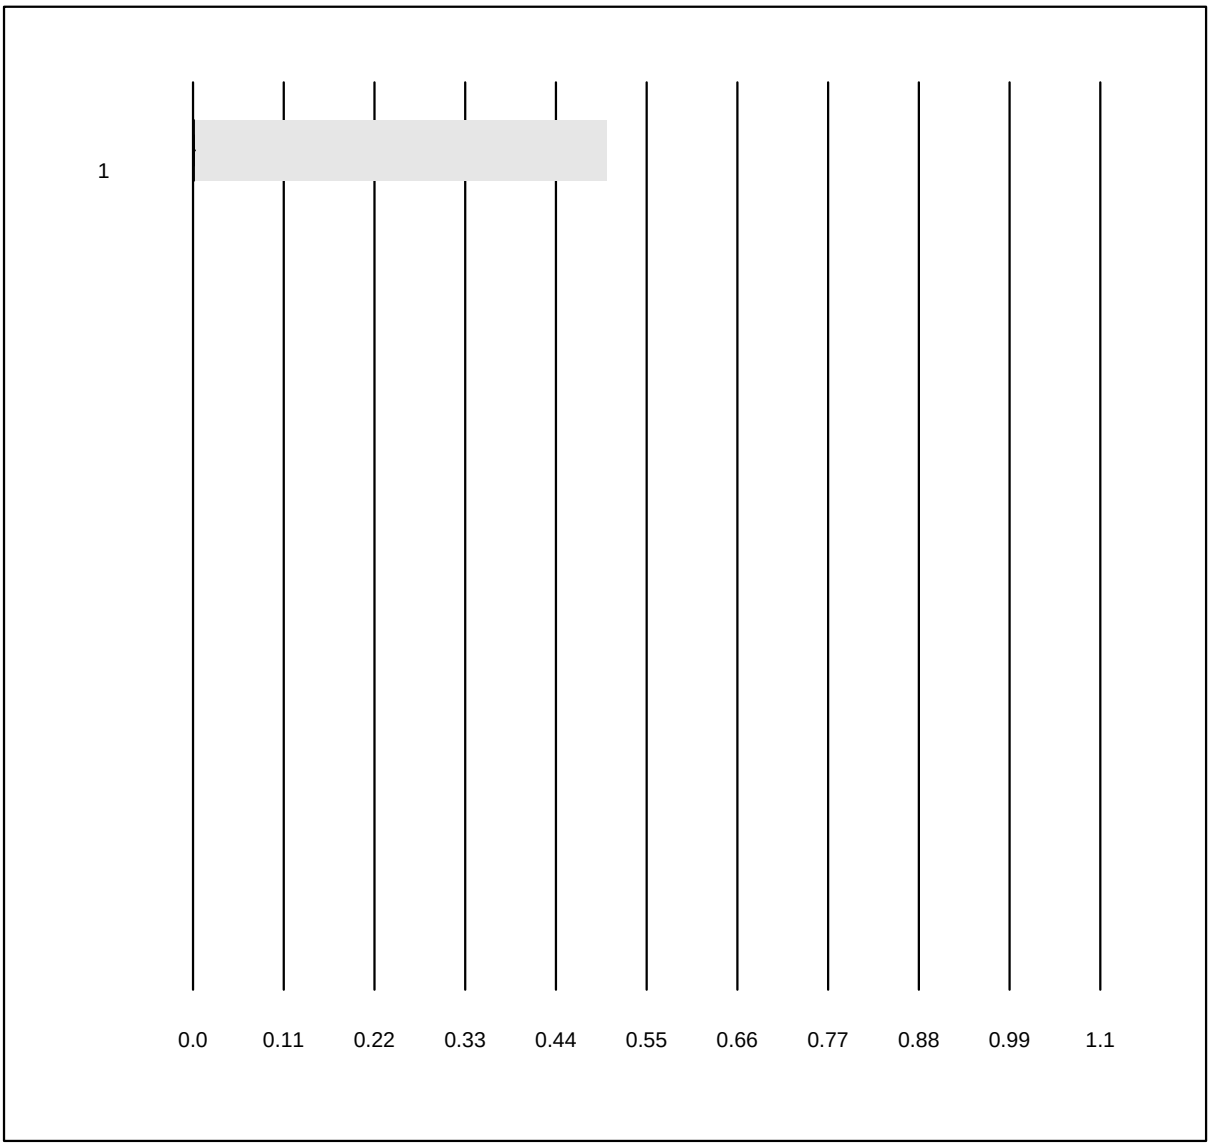


QUALAB Toleranz: 0%
(< 15.0: +/- 0.5 Log10 IU/ml)

HCV NAT qn (Log10 IU/ml)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	toutes les méthodes	11	100.0	0.0	0.0	0.00	0.0	e

HIV1 NAT qn

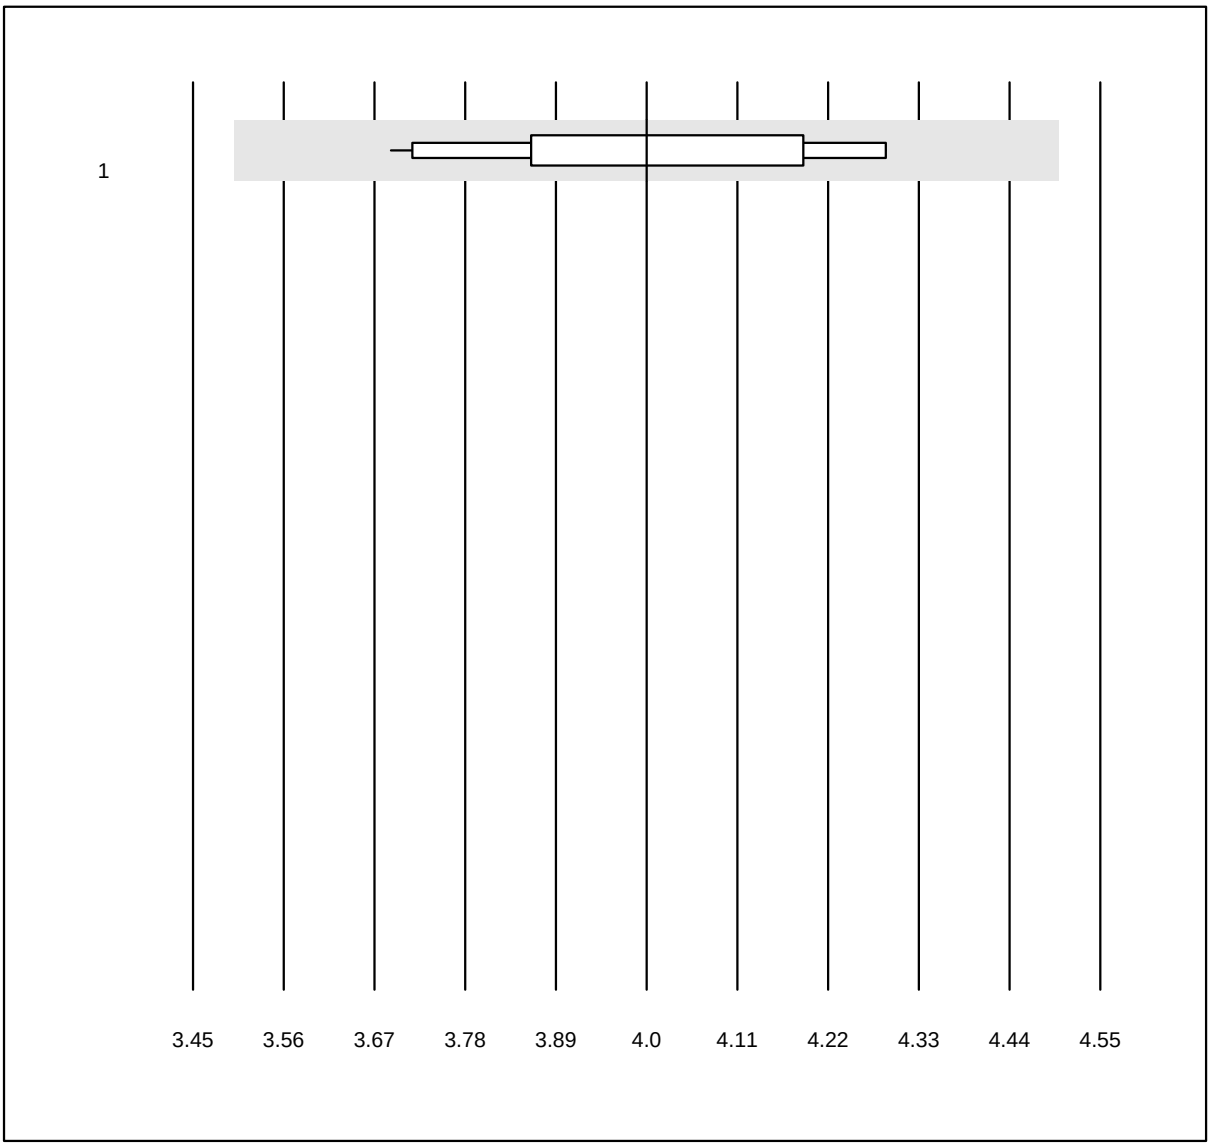


QUALAB Toleranz: 0%
(< 15.0: +/- 0.5 Log10 cp/ml)

HIV1 NAT qn (Log10 cp/ml)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	toutes les méthodes	11	100.0	0.0	0.0	4.00	5.1	a*

Anti-HBs Ig totale qn échantillon A

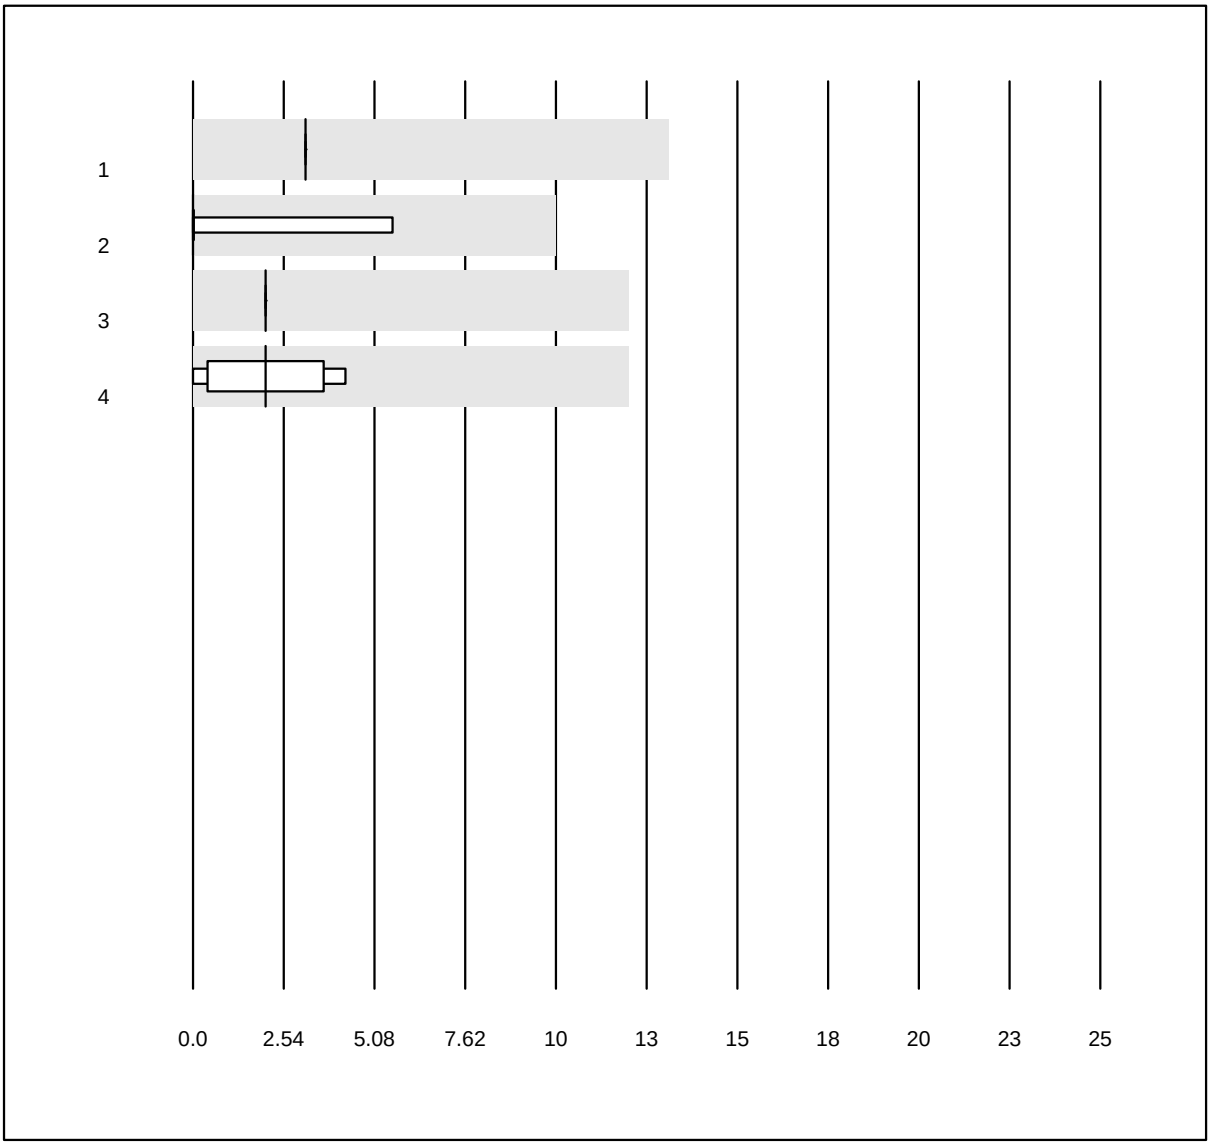


QUALAB Toleranz: 30%
(< 30.0: +/- 10.0 U/l)

Anti-HBs Ig totale qn
échantillon A (U/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Siemens	5	100.0	0.0	0.0	3	0.0	e
2	Abbott	8	100.0	0.0	0.0	0	280.9	e
3	Roche	22	100.0	0.0	0.0	2	0.0	e
4	Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	2	84.1	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

HBs Ag qn échantillon B

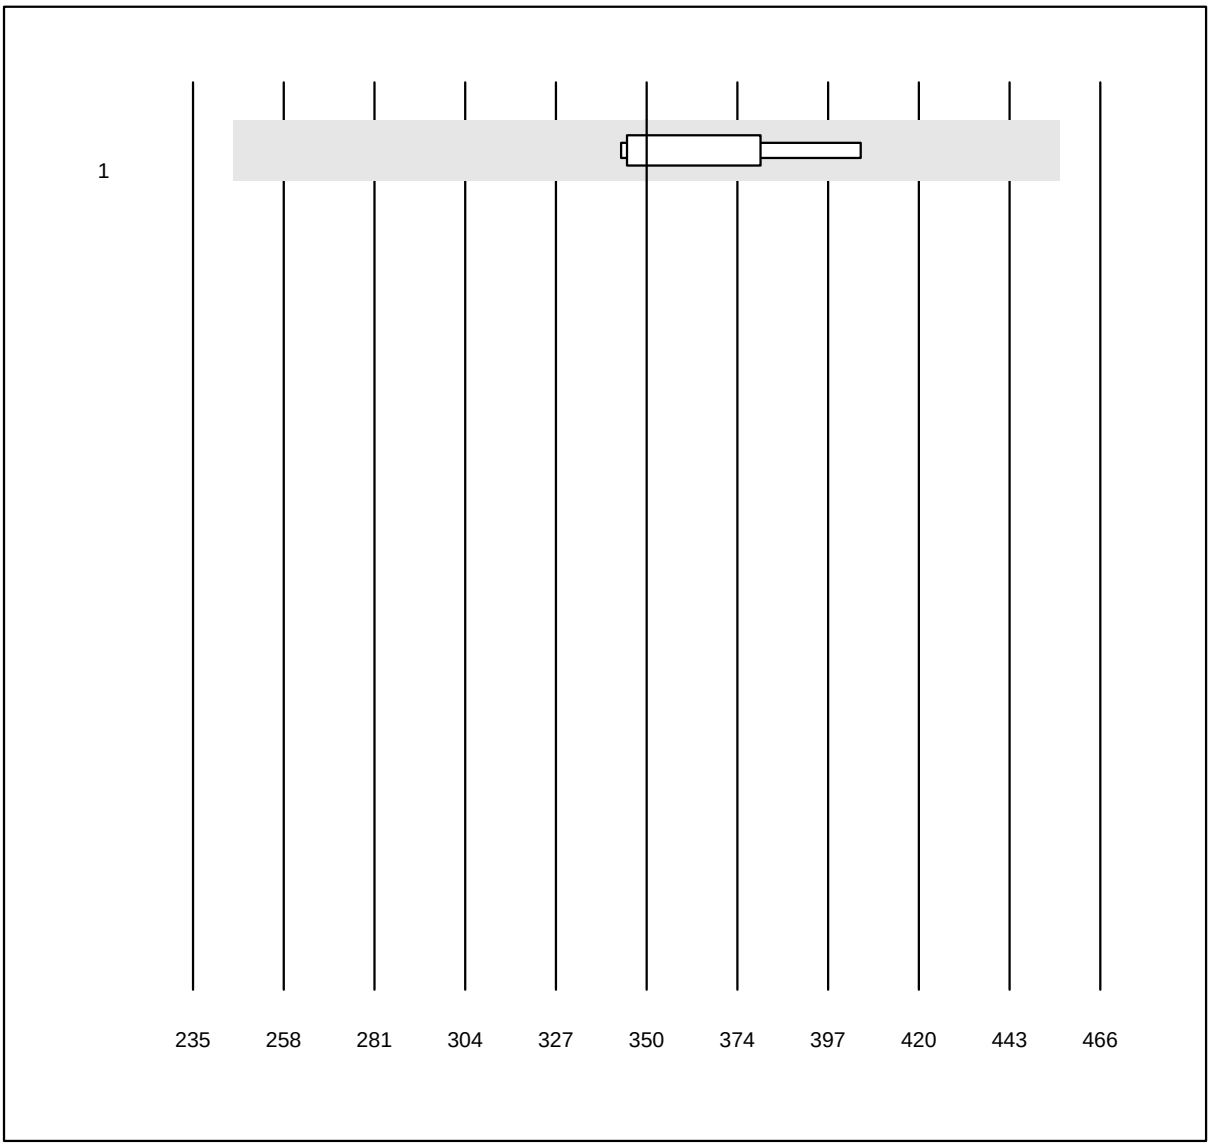


MQ Toleranz: 30%

HBs Ag qn échantillon B
(U/ml)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Roche	4	100.0	0.0	0.0	351	5.6	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)

Anti-HBs Ig totale qn échantillon B

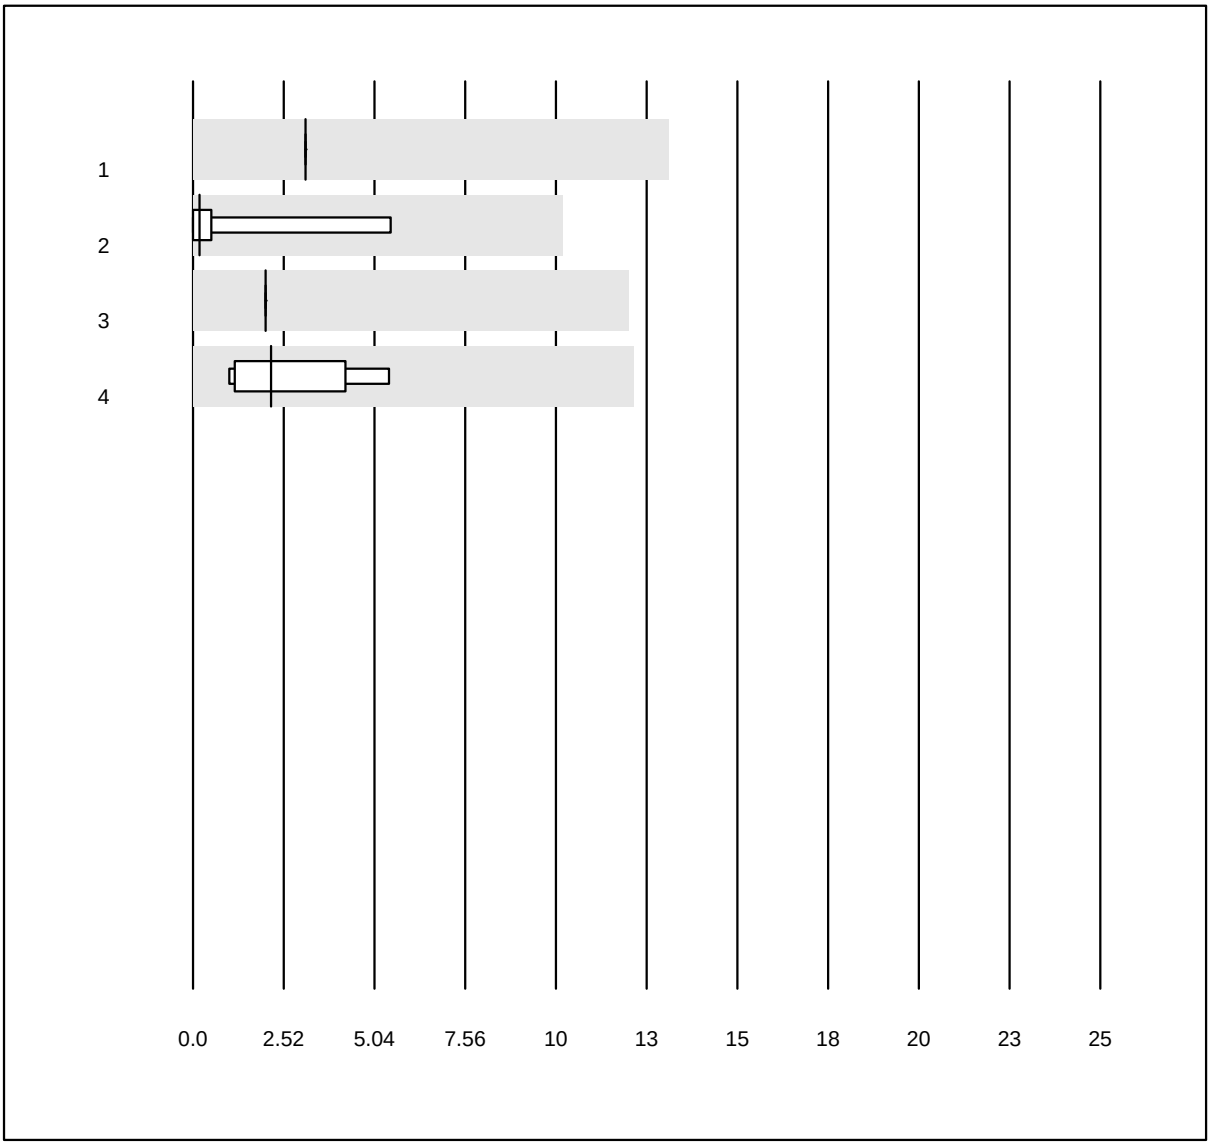

QUALAB Toleranz: 30%
(< 30.0: +/- 10.0 U/l)

Anti-HBs Ig totale qn
échantillon B (U/l)

No.	Méthode	Total	% OK	% insuff.	% évadé	Valeur cible	VK %	Type
1	Siemens	5	100.0	0.0	0.0	3	0.0	e
2	Abbott	8	100.0	0.0	0.0	0	217.2	e
3	Roche	22	100.0	0.0	0.0	2	0.0	e
4	Autres méthodes	4	100.0	0.0	0.0	2	65.6	e

1 autres résultats ont été remis, mais n'ont pas été publiés, car les groupes de méthodes étaient trop petits. (<4 rés. par groupe)