



Verein für medizinische Qualitätskontrolle
Association pour le contrôle de Qualité médical
Associazione per il controllo di qualità medico

Association pour le contrôle de qualité médical

Ouvrir le navigateur et se connecter

Pour des raisons de sécurité, veuillez toujours utiliser un navigateur actuel. Les navigateurs obsolètes mettent en danger votre informatique!



Online.mqzh.ch

Votre nom d'utilisateur est votre numéro de participant. Nous vous avons déjà envoyé votre mot de passe. Si vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe, vous pouvez utiliser la fonction "Mot de passe oublié".

MQ Online — Login

Deutsch | Français | Italiano | English

Nom d'utilisateur (numéro de participant)

Mot de passe [Mot de passe oublié?](#)

rappeler

login

Accéder à la feuille de protocole

The screenshot shows the 'MQ Online' user interface. On the left is a sidebar menu with options: 'Tableau de bord', 'Evaluations', 'Certificats', 'Saisir les résultats', 'Paramètres', and 'Déconnexion'. A red arrow points to 'Saisir les résultats'. The main area contains a table with columns: 'Période', 'Date limite', 'statut essais interlaboratoires', 'vos résultats', and 'Document'. Two rows are visible: one for '2020-2' with a deadline of '05.06.2020' and status 'échantillons envoyés', and another for '2020-1' with a deadline of '03.04.2020' and status 'terminé'. A red arrow points to the 'Saisir vos résultats' link in the first row.

Période	Date limite	statut essais interlaboratoires	vos résultats	Document
2020-2	05.06.2020	échantillons envoyés	Saisir vos résultats	0 fichier Télécharger
2020-1	03.04.2020	terminé	Résultats transmis	0 fichier

Saisir les résultats et terminer

Activez l'essai interlaboratoire souhaité et entrez la valeur. S'il y a plusieurs valeurs par échantillon, vous pouvez passer au champ suivant à l'aide de la touche de tabulation.

The screenshot shows the data entry form for an interlaboratory test. At the top, there is a button labeled 'Les Informations sur l'étude collaborative et les données des patients'. Below this, a list of tests is shown: 'I09-Allergologie Immunocap RAP (0/10)', 'K01-Chimie (0/4)', and 'K03A-HbA1c (0/1)'. A red arrow points to 'K03A-HbA1c (0/1)'. Below the list is a table with columns: 'substance', 'appareil', and 'valeur'. The first row shows 'HbA1c échantillon A' and 'A1c Now' with an empty input field. A red arrow points to this input field. To the right of the input field is a '%' symbol and a smiley face icon. Below the table is an 'observation' field and a dropdown menu for 'qualité de l'échantillon' with 'bon' selected.

substance	appareil	valeur
HbA1c échantillon A	A1c Now	<input type="text"/>

Dès que toutes les valeurs ont été saisies, vous pouvez terminer le processus.

Si vous ne cliquez que sur «terminer définitivement», vous pourrez vous reconnecter à tout moment et entrer d'autres valeurs. Attention: dans ce cas, l'envoi de l'essai interlaboratoire n'est encore pas effectué.

K08-Herzinfarktmarker h232 (0/4)

U02-Urin Teststreifen/HCG (0/10)

U04-Urinsediment (0/5)

Erfassung abschließen

 Print

Terminer la saisie

Après la saisie, les données ne peuvent plus être modifiées.

Oui, je voudrais terminer définitivement la saisie

 Print

terminer


Si vous cliquez uniquement sur "terminer la saisie", vous pouvez vous reconnecter à tout moment et saisir d'autres valeurs. Attention : dans ce cas, l'envoi de l'essai interlaboratoire n'a pas encore eu lieu.

L'essai interlaboratoire ne sera envoyé que lorsque vous aurez cliqué sur «terminer définitivement». Dès lors, vous ne pourrez plus modifier aucune valeur en ligne.

Questions et réponses

Connexion impossible Message d'erreur «page expired»

Appuyez sur le symbole à côté de la ligne de saisie. Sélectionnez «Cookies» et supprimez-les.

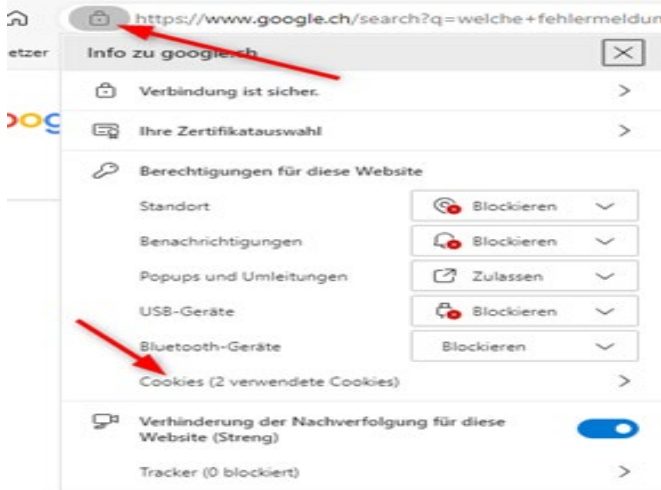


La connexion ne fonctionne pas et le mot de passe ne peut pas être réinitialisé. Que faire ?

Il est possible que l'adresse e-mail que nous avons dans notre système soit erronée. Envoyez-nous un mail à info@mqzh.ch ou appelez-nous.

Pourquoi y a-t-il un smiley à côté de l'analyse?

Si vous ne parvenez pas à saisir une valeur, nous souhaiterions savoir pourquoi. Cette fonction nous permet d'adapter correctement votre protocole pour le prochain essai interlaboratoire.

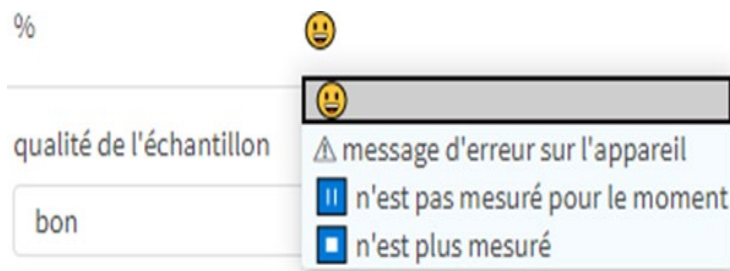

Quel type de remarques peut-on faire ?

Si vous mesurez d'autres analyses à partir de l'échantillon, vous pouvez saisir les valeurs ici.

De même, si vous travaillez avec un nouvel appareil ou si vous utilisez une autre unité.