

# Association pour le contrôle de qualité médical


## Saisir les résultats des essais interlaboratoires en trois étapes

### 1. Ouvrir le navigateur et se connecter

Pour des raisons de sécurité, veuillez toujours utiliser un navigateur actuel. Les navigateurs obsolètes mettent en danger votre informatique!



[online.mqzh.ch](https://online.mqzh.ch)

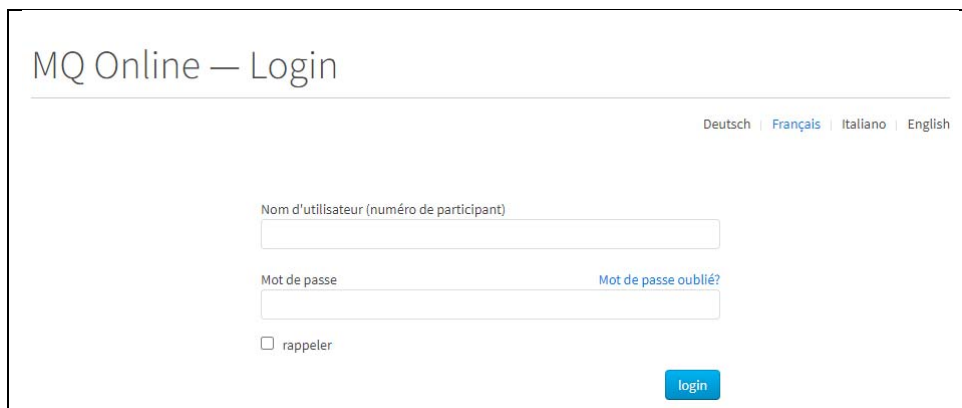

Vous trouverez vos données utilisateur sur le bordereau de livraison de l'actuel essai interlaboratoire.

Si vous avez déjà utilisé votre mot de passe, il n'y apparaîtra plus. Si vous ne connaissez plus votre mot de passe, vous pouvez utiliser la fonction «mot de passe oublié».

### 2. Accéder à la feuille de protocole



Période	Date limite	statut essais interlaboratoires	vos résultats	Document
2020-2	05.06.2020	échantillons envoyés	Saisir vos résultats	0 fichier: Télécha
2020-1	03.04.2020	terminé	Résultats transmis	0 fichier:

### 3. Saisir les résultats et terminer

Activez l'essai interlaboratoire souhaité et entrez la valeur.

S'il y a plusieurs valeurs par échantillon, vous pouvez passer au champ suivant à l'aide de la touche de tabulation.

Les informations sur l'étude collaborative et les données des patients

---

I09-Allergologie Immunocap RAP ( 0/10)

---

K01-Chimie ( 0/4)

---

**K03A-HbA1c ( 0/1)**

substance	appareil	valeur	
HbA1c échantillon A	A1c Now	<input type="text"/>	%

observation

qualité de l'échantillon

bon

Dès que toutes les valeurs ont été saisies, vous pouvez terminer le processus.

I09-Allergologie Immunocap RAP ( 0/10)

---

K01-Chimie ( 0/4)

---

K03A-HbA1c ( 0/1)

---

Terminer la saisie

Print

Terminer la saisie

Après la saisie, les données ne peuvent plus être modifiées.

Oui, je voudrais terminer définitivement la saisie

Print

**terminer**

L'essai interlaboratoire ne sera envoyé que lorsque vous aurez cliqué sur «terminer définitivement». Dès lors, vous ne pourrez plus modifier aucune valeur en ligne.

Si vous ne cliquez que sur «terminer», vous pourrez vous reconnecter à tout moment et entrer d'autres valeurs. Attention: dans ce cas, l'envoi de l'essai interlaboratoire n'est encore pas effectué.



## Questions et réponses

### 1. La connexion ne fonctionne pas et le mot de passe ne peut pas être réinitialisé. Que faire?

Il est possible que l'adresse e-mail que nous avons dans notre système soit erronée.

Envoyez-nous un mail à [info@mqzh.ch](mailto:info@mqzh.ch) ou appelez-nous.

### 2. La connexion n'apparaît pas ou une page vide apparaît

Utilisez un navigateur actuel. Les navigateurs obsolètes tels qu'Internet Explorer présentent un risque de sécurité, et ils ne peuvent pas toujours afficher correctement les sites Web modernes.


### 3. Que signifie «documents supplémentaires»?

Veuillez n'utiliser cette fonction qu'après nous avoir consulté.

La saisie des résultats en ligne suffit, veuillez ne pas nous envoyer votre feuille de protocole.

### 4. Pourquoi y a-t-il un smiley à côté de l'analyse?

Si vous ne parvenez pas à saisir une valeur, nous souhaiterions savoir pourquoi. Cette fonction nous permet d'adapter correctement votre protocole pour le prochain essai interlaboratoire.

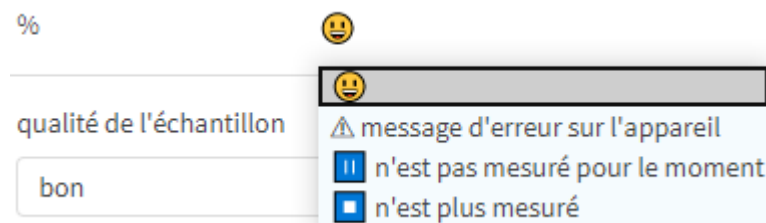

### 5. Quel type de remarques peut-on faire?

Si vous mesurez des analyses supplémentaires à partir de l'échantillon, vous pouvez saisir les valeurs ici. Ou si vous travaillez avec un nouvel appareil, ou si vous utilisez une autre unité.

01.06.2020